



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых
маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i
(Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения**


**производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road,Hi-tech
Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of Ch**

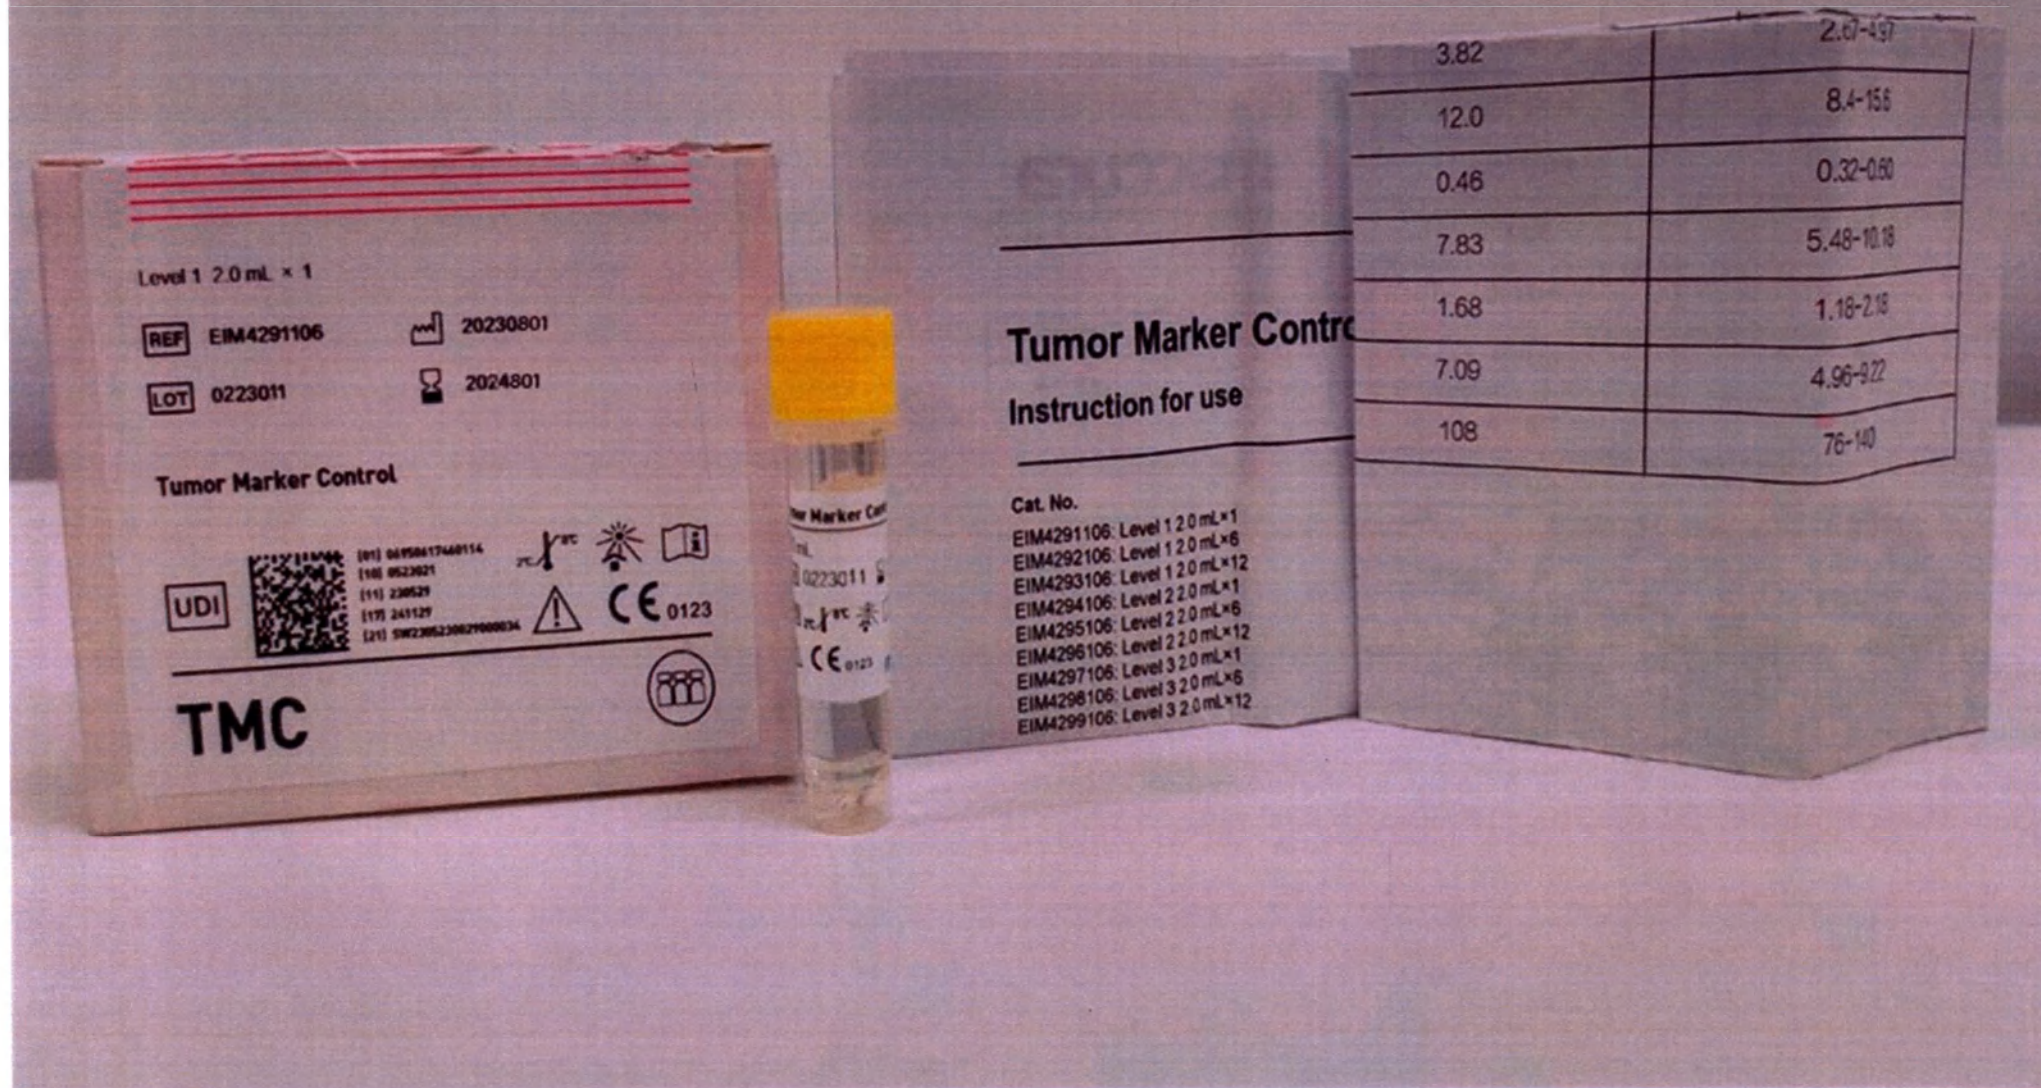

Общий вид медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 1

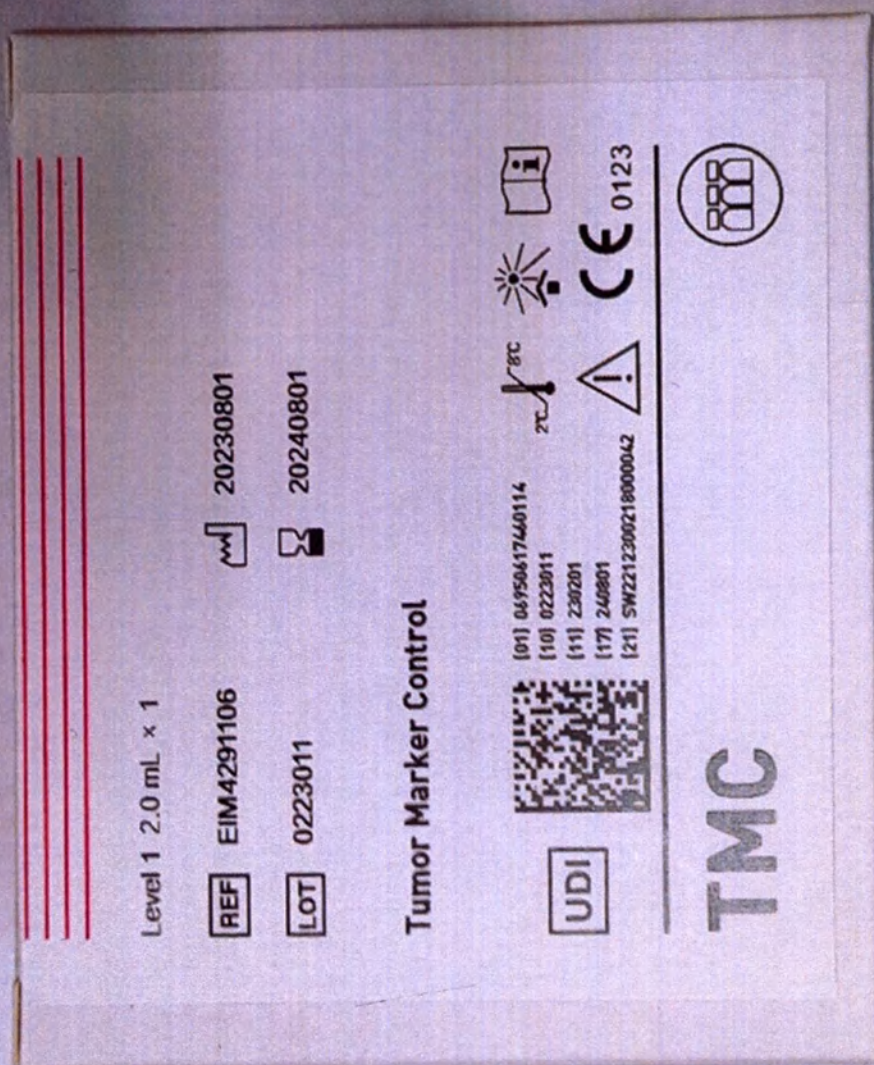


Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид спереди.

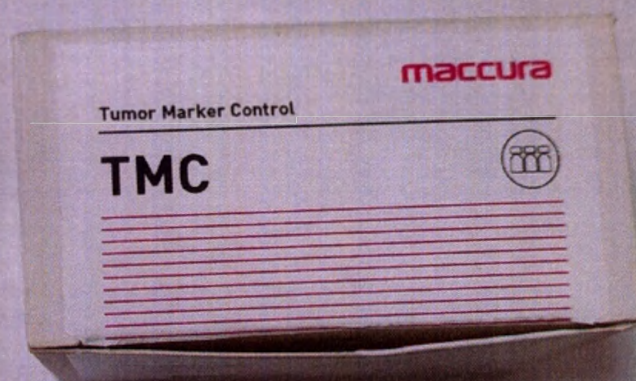

Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид сверху.



Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид сбоку.

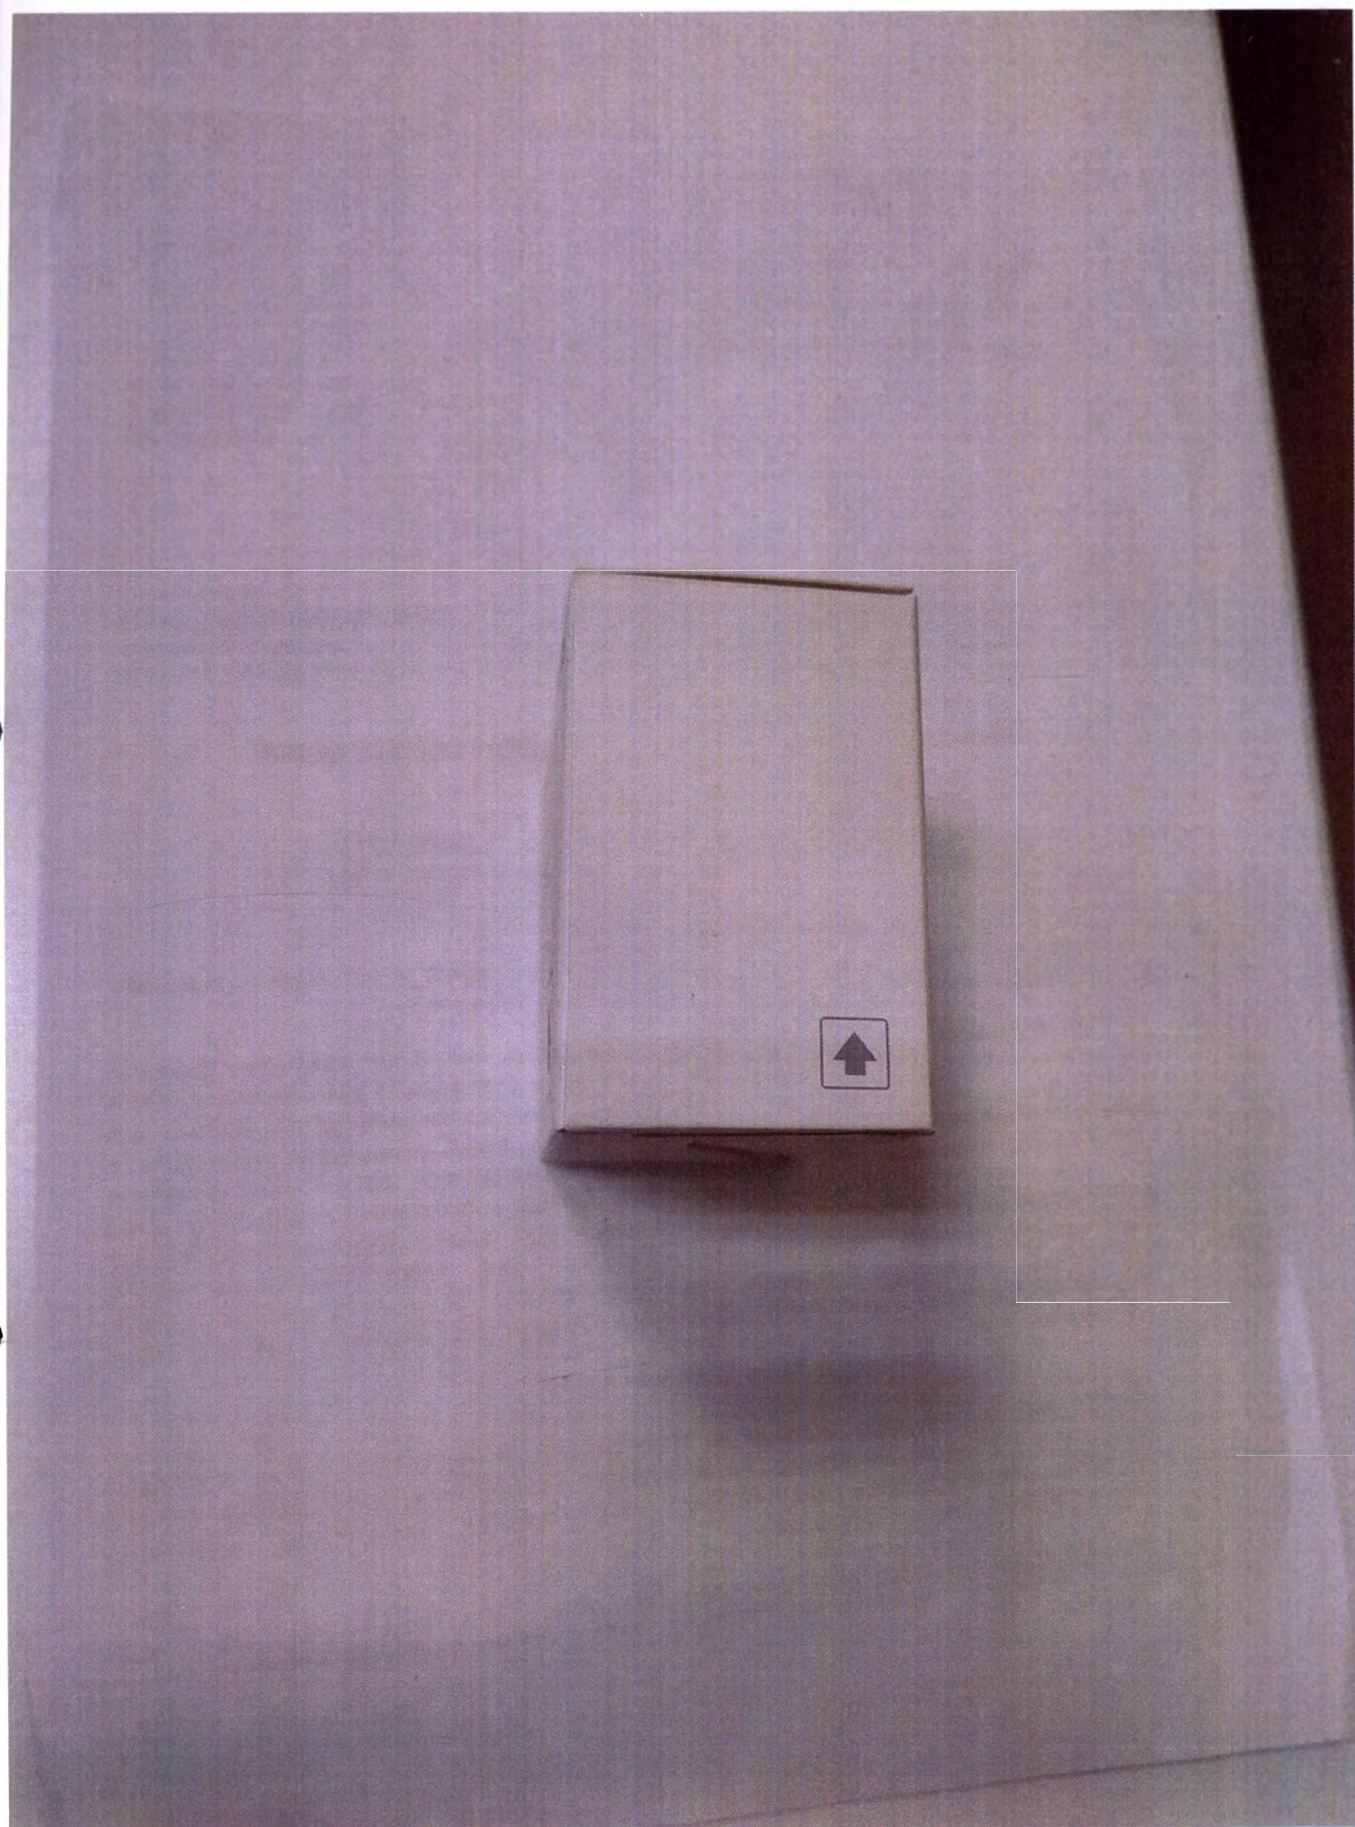


Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид сбоку.






Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Massiga i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид сзади.



Пробирка содержащая «Материал контрольный 1 (Level 1)» - сторона 1.

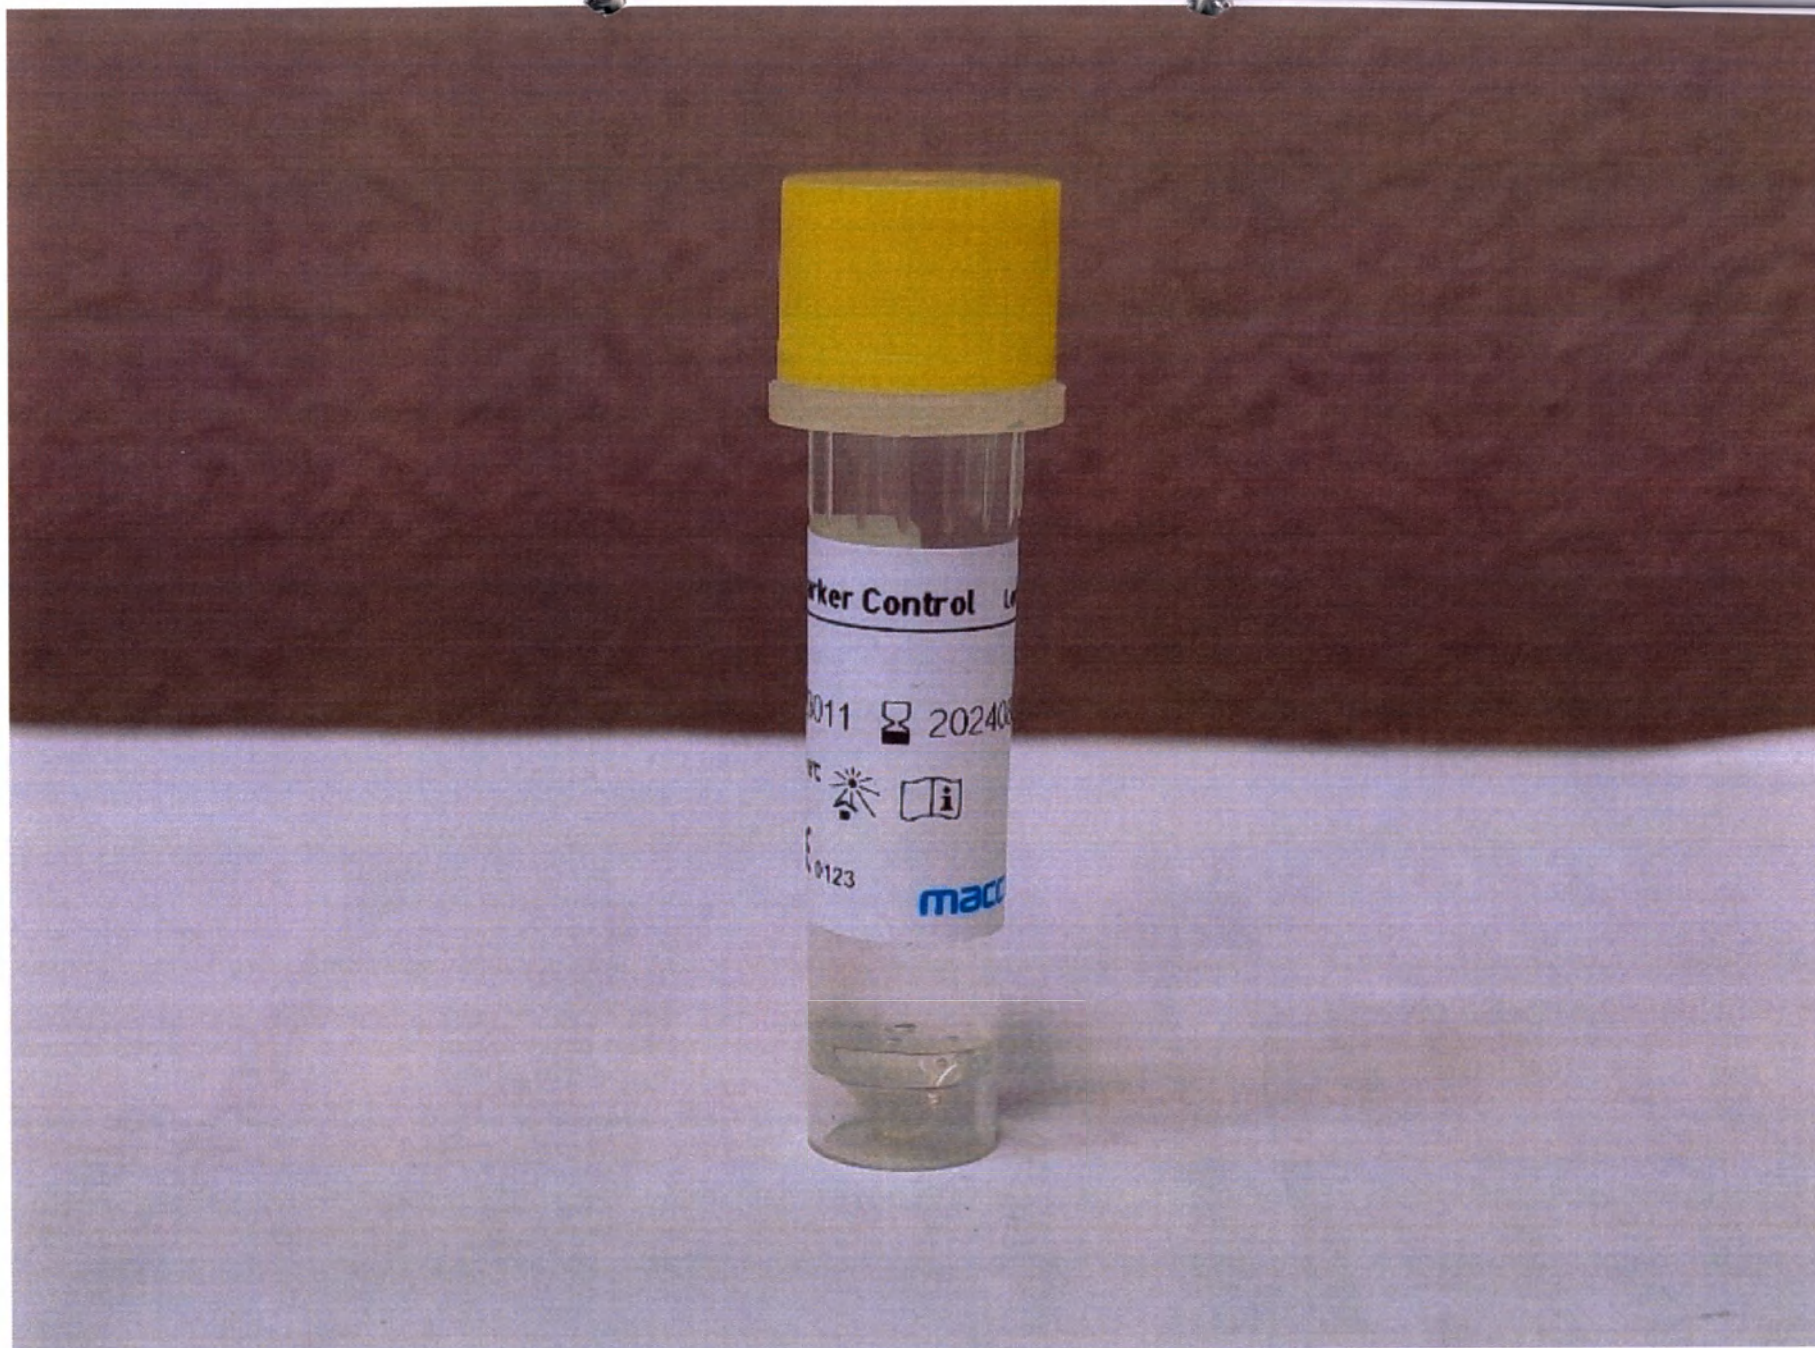

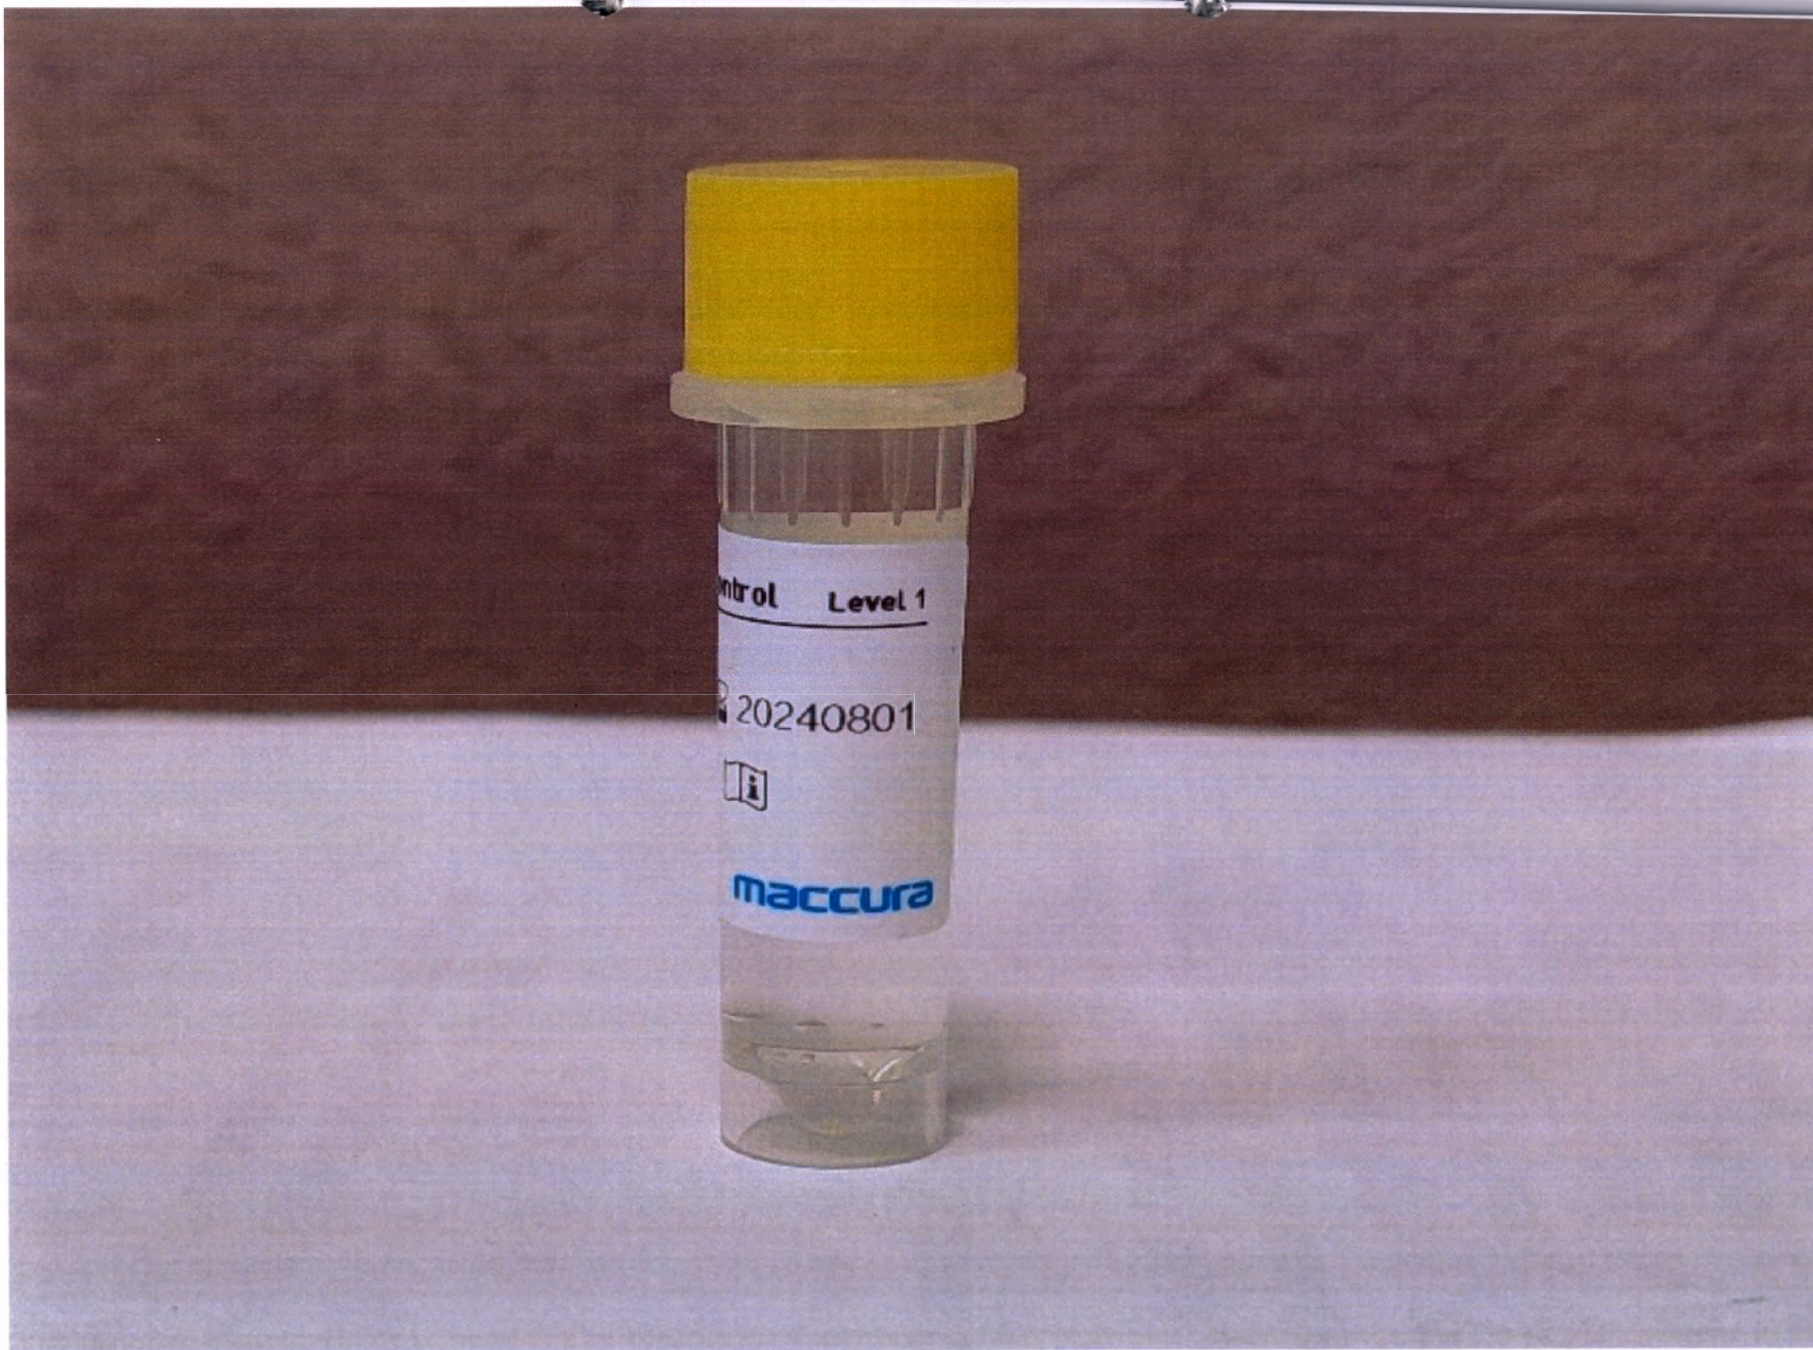

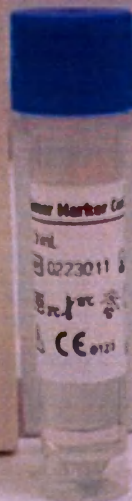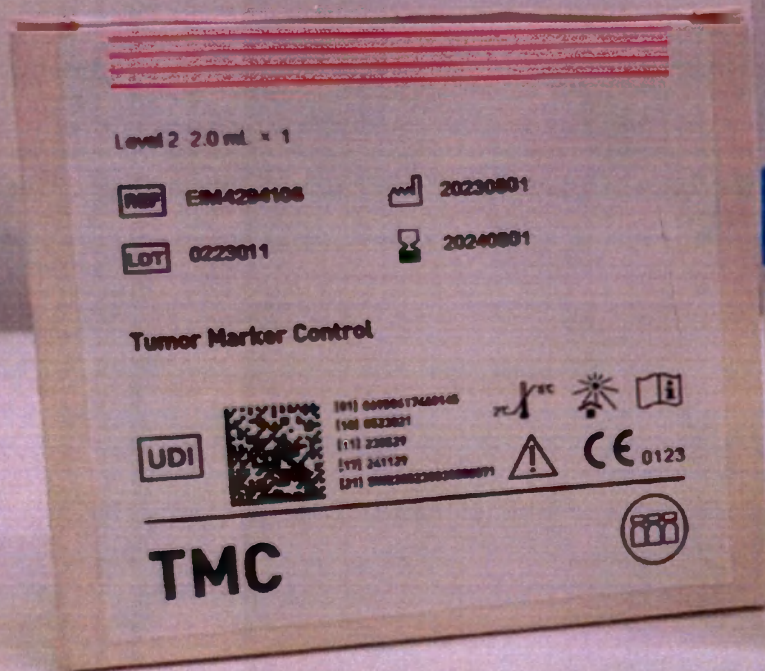

Tumor Marker Control

Instruction for use

Cat. No.

EIM4291108: Level 1 2.0 mL x 1
 EIM4292108: Level 1 2.0 mL x 6
 EIM4293108: Level 1 2.0 mL x 12
 EIM4294108: Level 2 2.0 mL x 1
 EIM4295108: Level 2 2.0 mL x 6
 EIM4296108: Level 2 2.0 mL x 12
 EIM4297108: Level 3 2.0 mL x 1
 EIM4298108: Level 3 2.0 mL x 6
 EIM4299108: Level 3 2.0 mL x 12

3.82	2.67-4.97
12.0	8.4-15.6
0.46	0.32-0.60
7.83	5.48-10.18
1.68	1.18-2.18
7.09	4.96-9.22
108	76-140

Общий вид медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 2»




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилуминесцентным методом на анализаторах Massura i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид спереди.



Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид сверху.




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Масскура i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид сбоку.

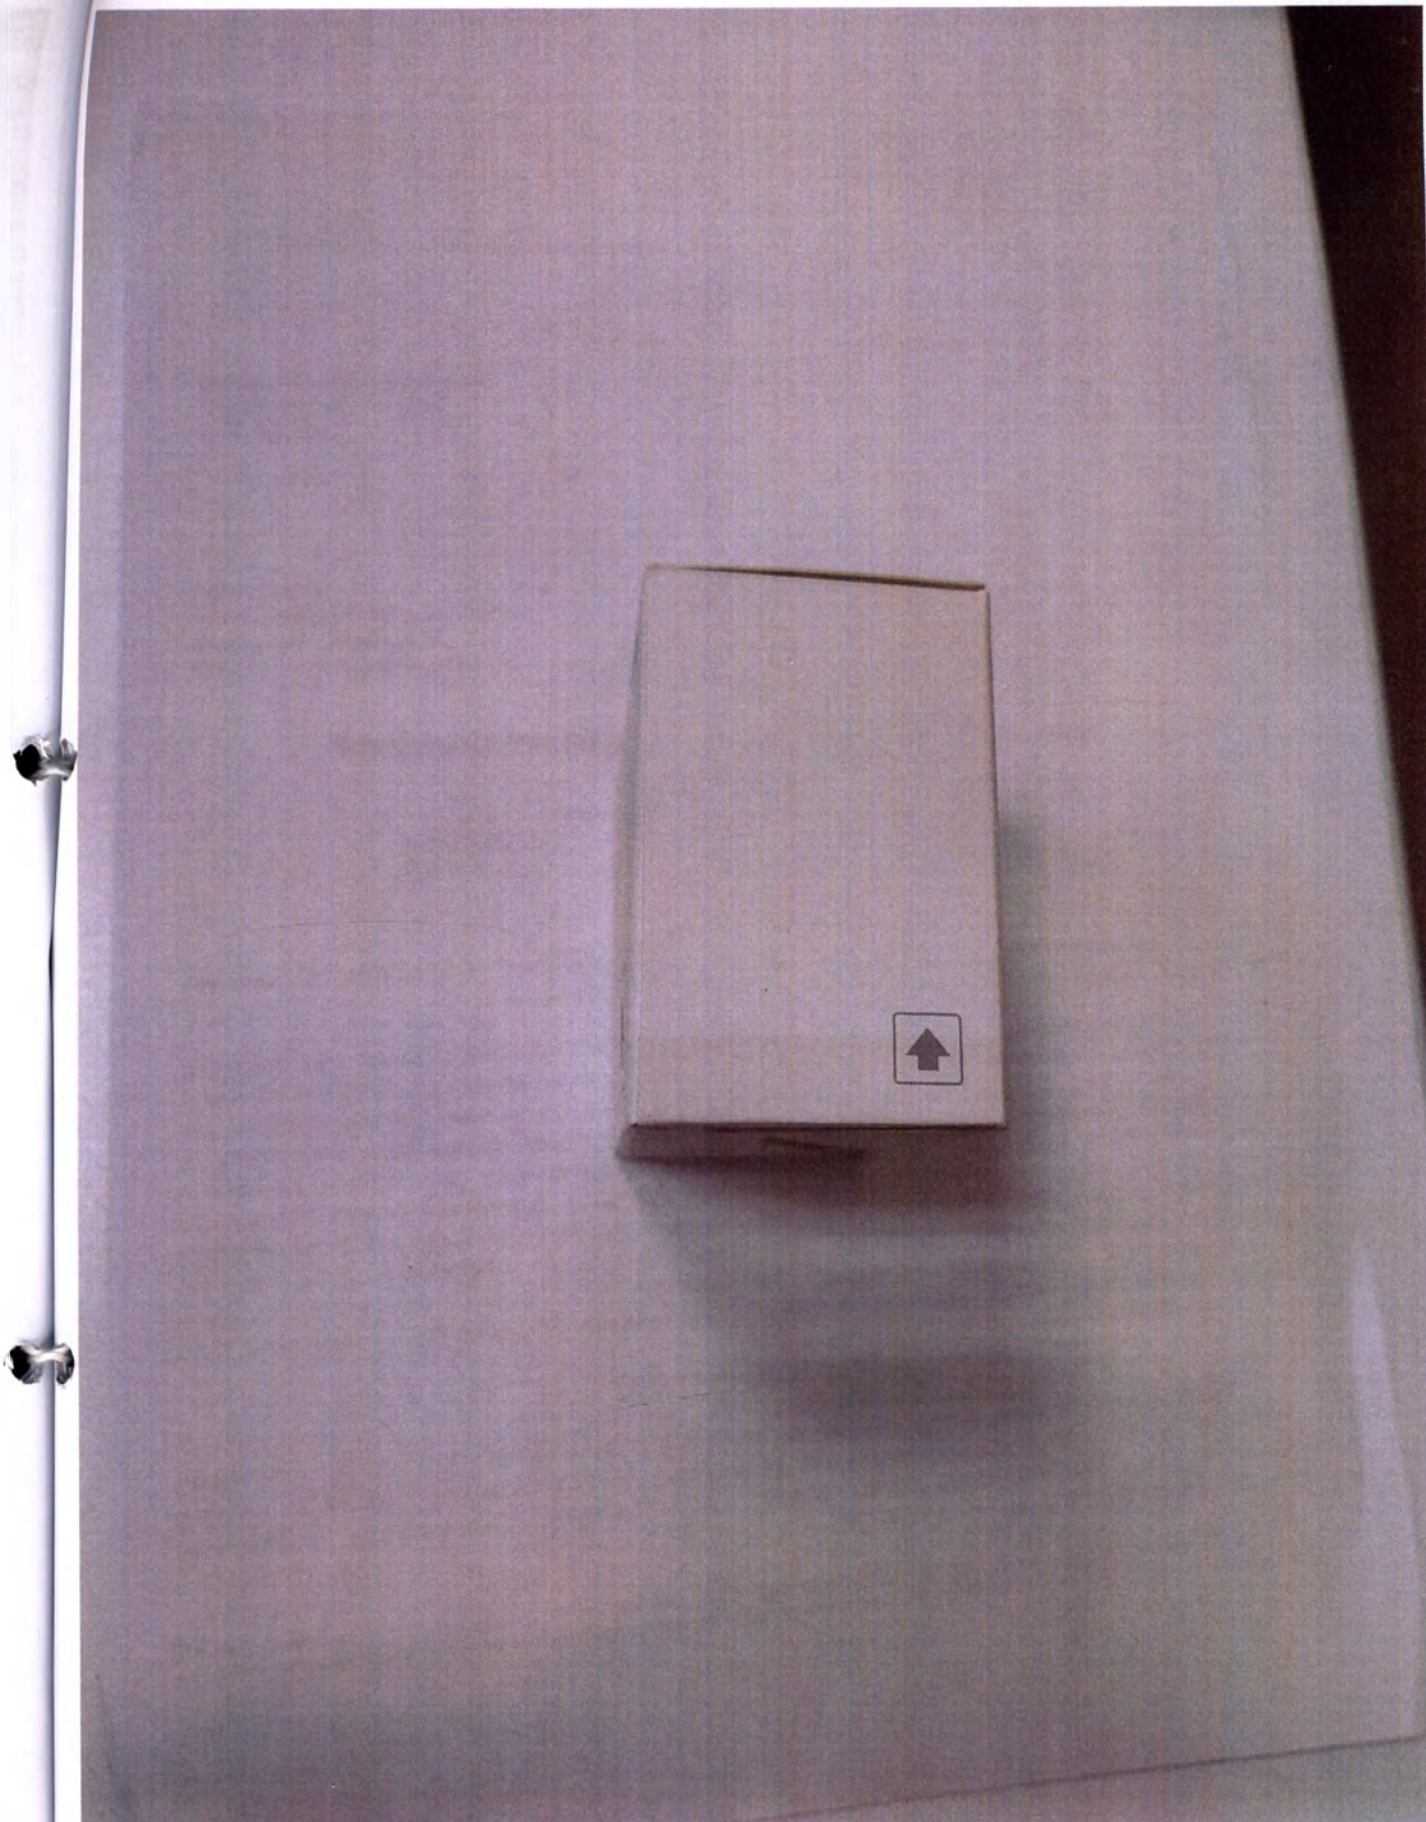


Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массига i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид сбоку.




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид сзади.

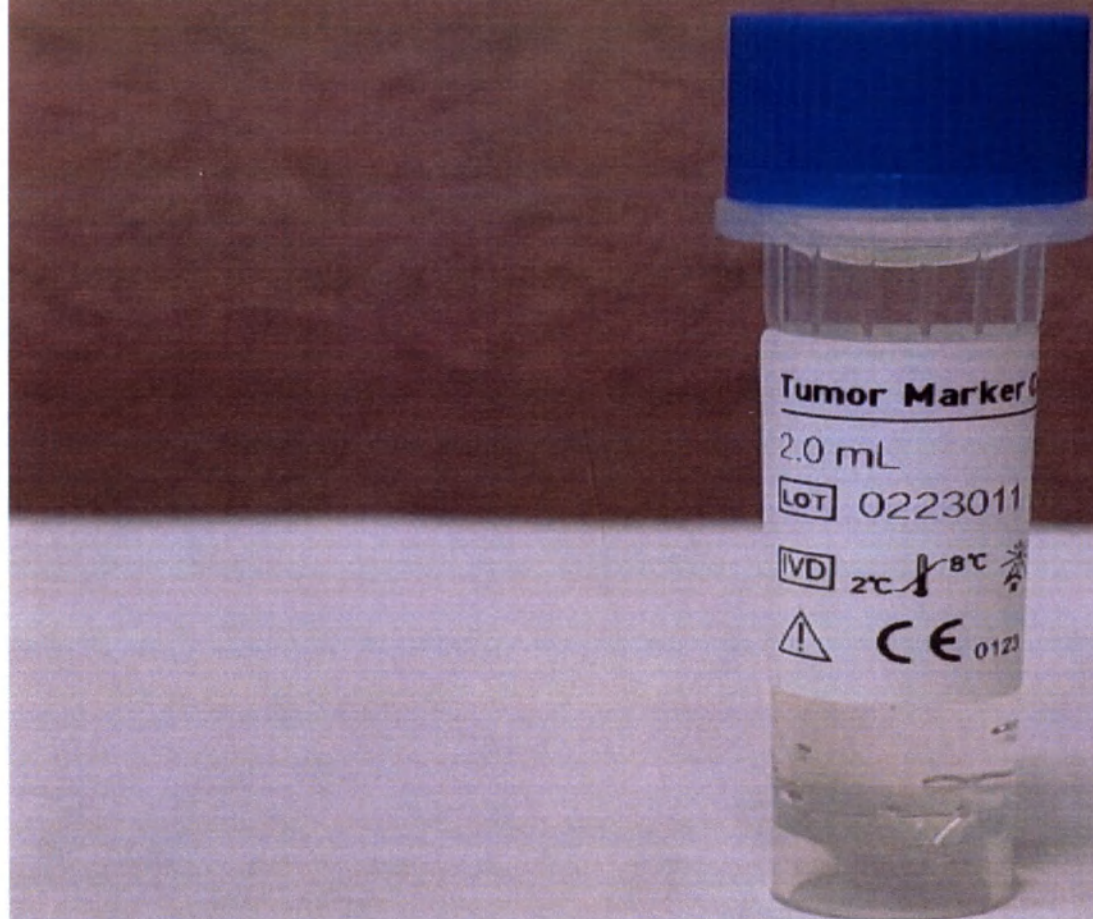


Пробирка содержащая «Материал контрольный 2 (Level 2)» - сторона 1.

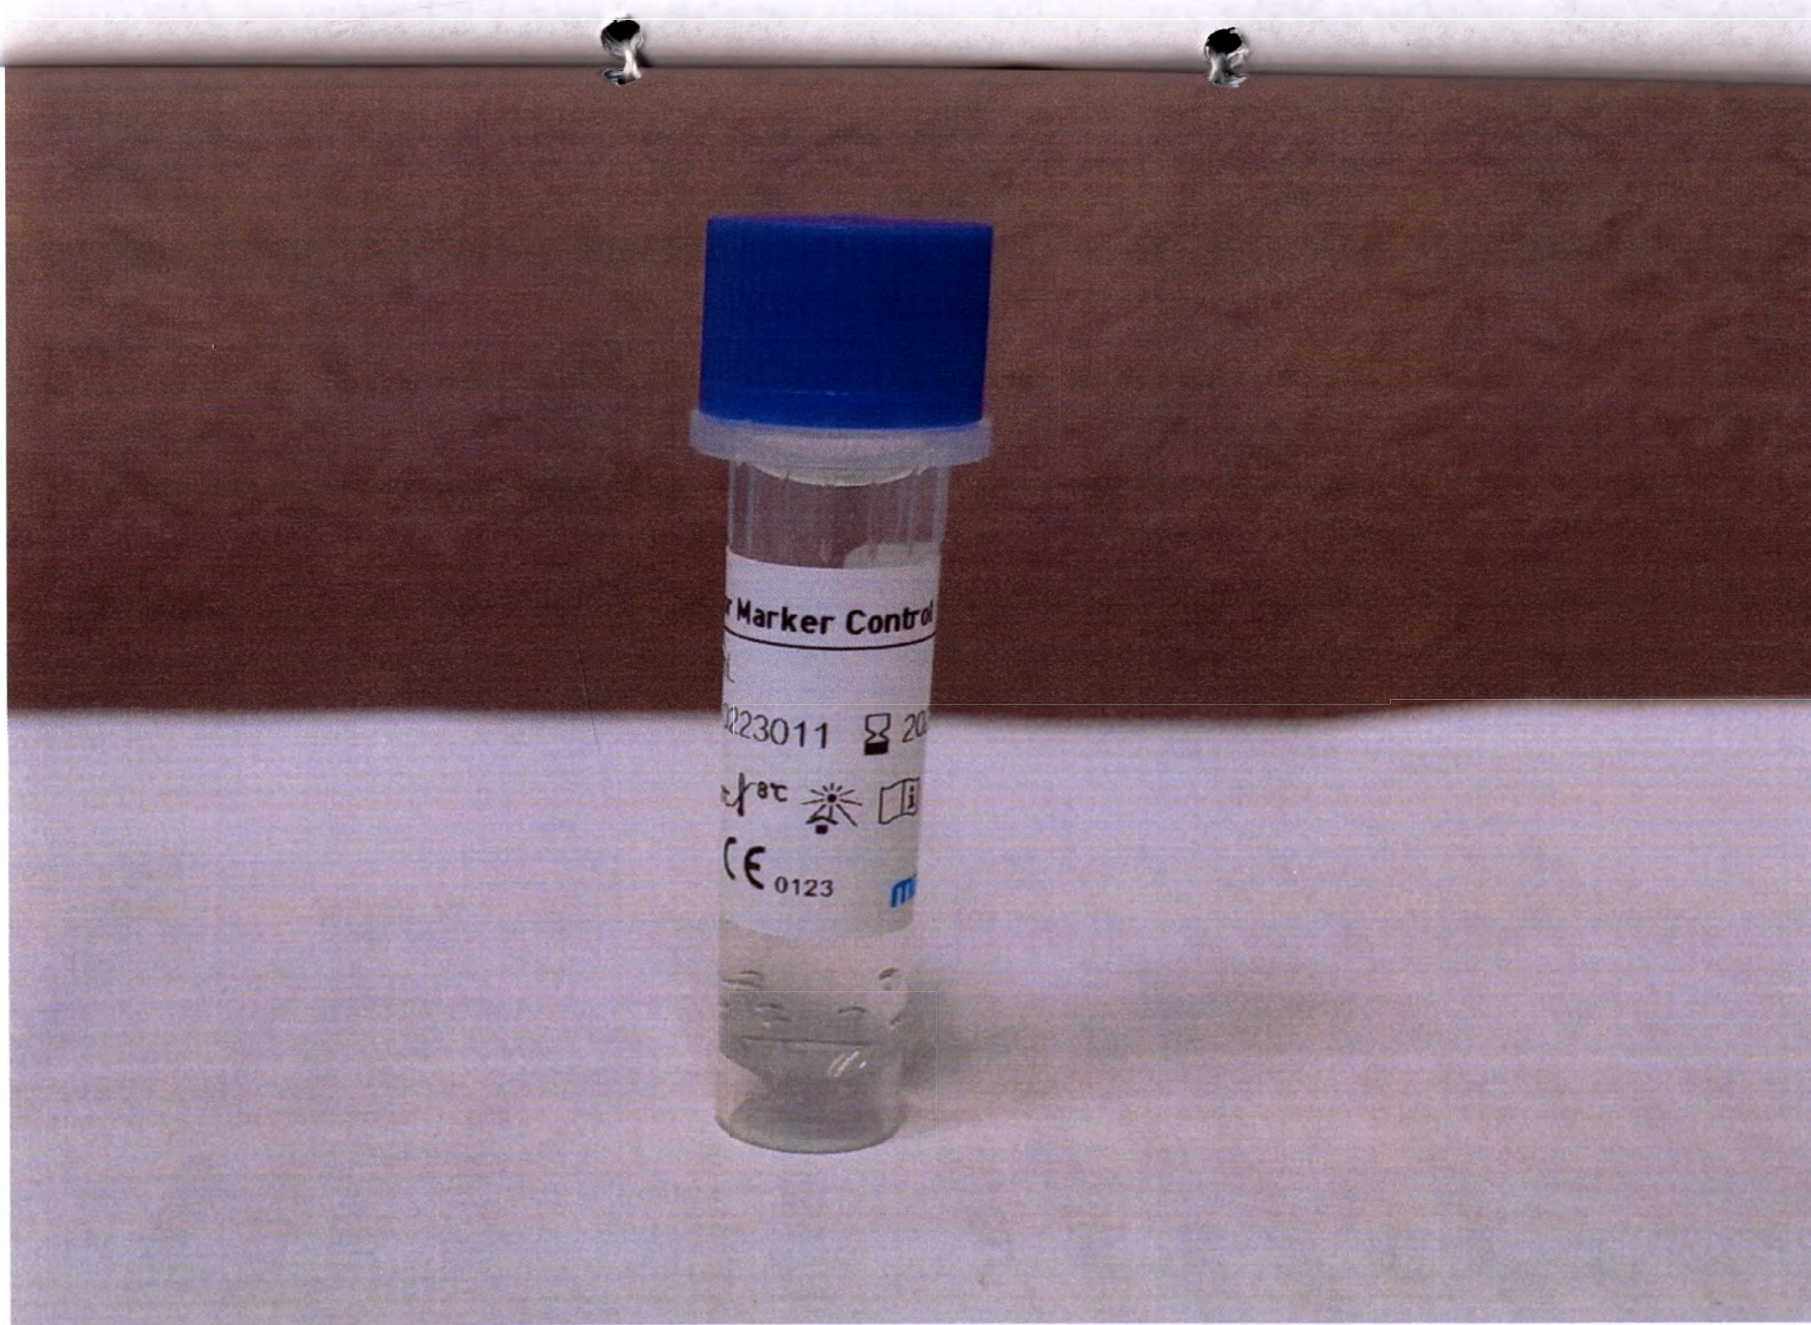

Пробирка содержащая «Материал контрольный 2 (Level 2)» - сторона 2.

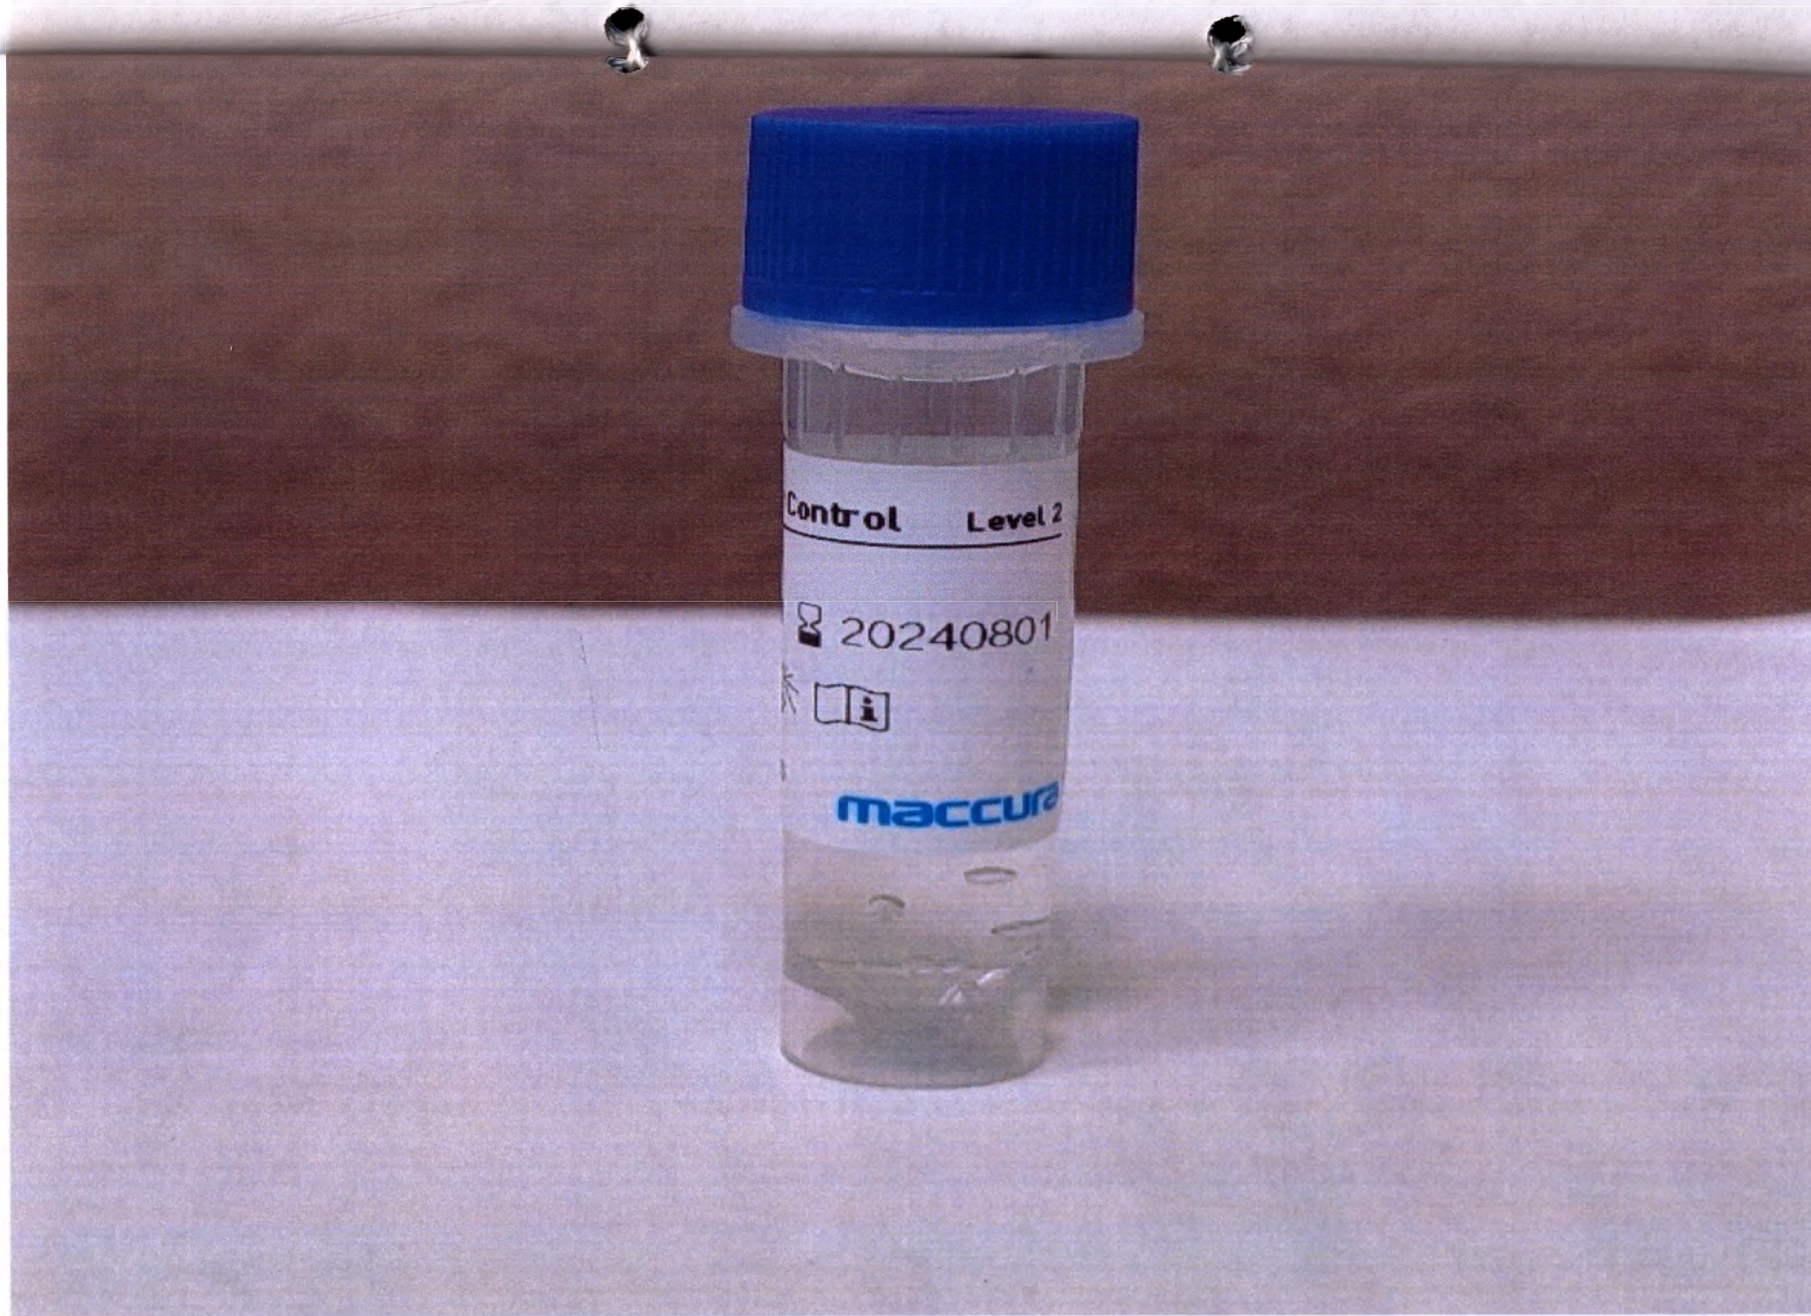

Пробирка содержащая «Материал контрольный 2 (Level 2)» - сторона 3.



Tumor Marker Control

Instruction for use

Cat. No.


EIM4291106: Level 1 2.0 mL x 1
 EIM4292106: Level 1 2.0 mL x 6
 EIM4293106: Level 1 2.0 mL x 12
 EIM4294106: Level 2 2.0 mL x 1
 EIM4295106: Level 2 2.0 mL x 6
 EIM4296106: Level 2 2.0 mL x 12
 EIM4297106: Level 3 2.0 mL x 1
 EIM4298106: Level 3 2.0 mL x 6
 EIM4299106: Level 3 2.0 mL x 12

3.82	2.67-4.97
12.0	8.4-15.6
0.46	0.32-0.60
7.83	5.48-10.18
1.68	1.18-2.18
7.09	4.96-9.22
108	76-140

Общий вид медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 3»




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Masscura i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 3» - вид спереди.

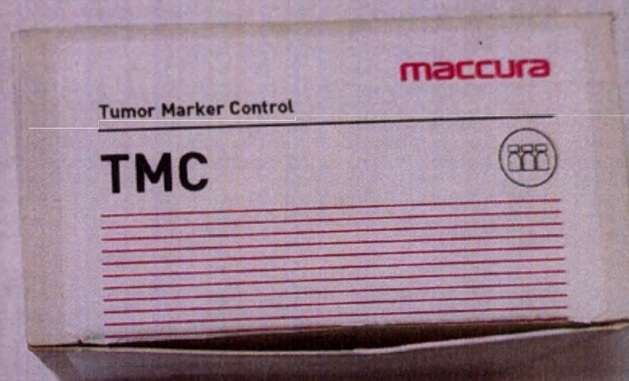

Историческая упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 3» - вид сверху.



Историческая упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Масскура i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 3» - вид сбоку.

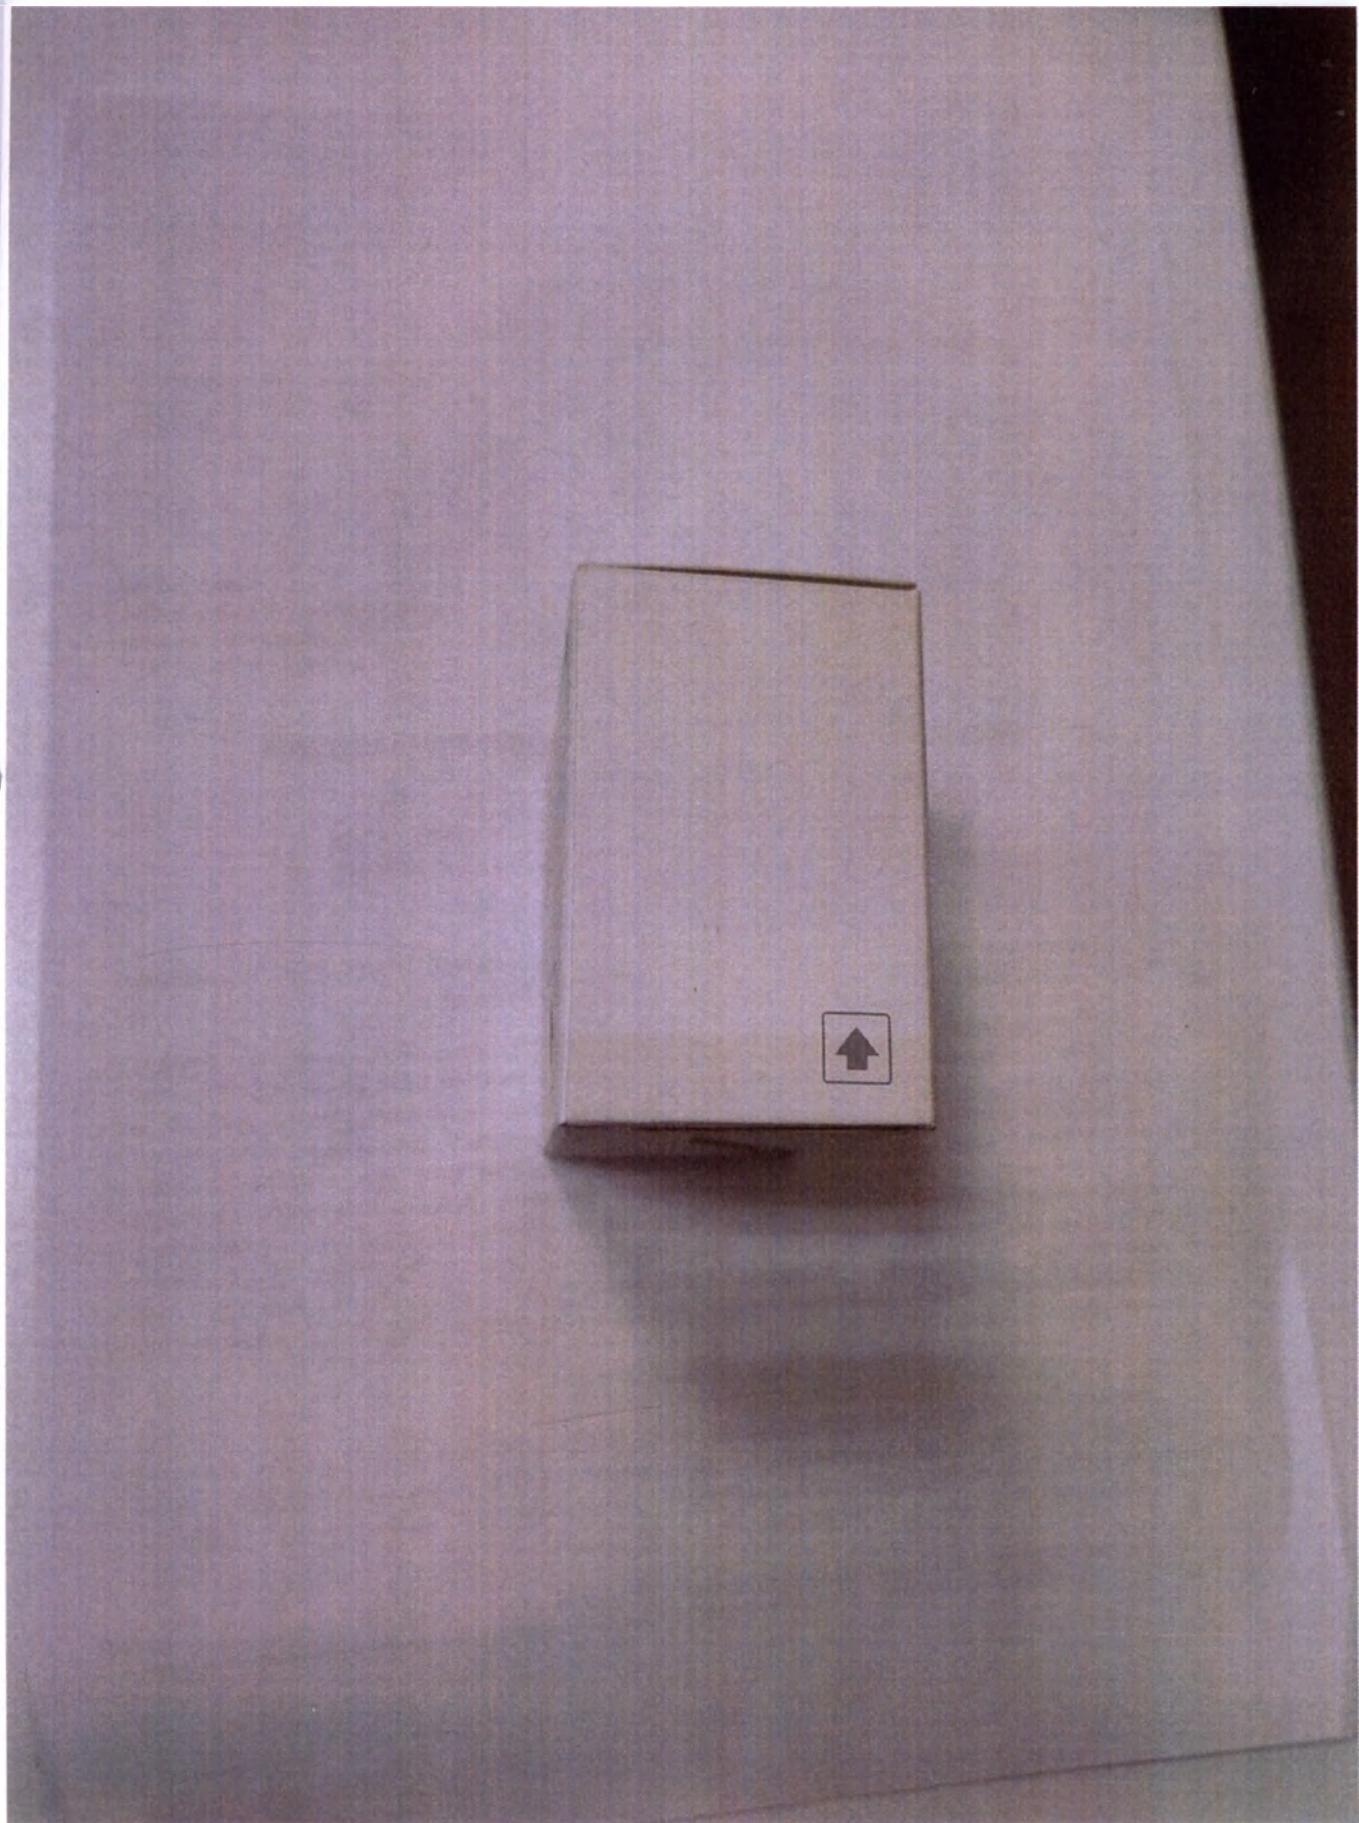

Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 3» - вид сбоку.

迈克生物股份有限公司
住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号
电话: + 86 28 8782 6777
传真: + 86 28 8782 5783
邮编: 611731
邮箱: maccura@maccura.com



Maccura Biotechnology Co., Ltd.
Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731
Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86 28 8782 6777
Fax: +86 28 8782 5783
E-mail: maccura@maccura.com

www.maccura.com



Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (Tumor Marker Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 3» - вид сзади.

迈克生物股份有限公司

住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号

电话: +86 28 8782 6777

传真: +86 28 8782 5783

邮编: 611731

邮箱: maccura@maccura.com



Maccura Biotechnology Co., Ltd.

Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731

Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86 28 8782 6777


Fax: +86 28 8782 5783

E-mail: maccura@maccura.com


www.maccura.com




оричная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества
пределения опухолевых маркеров иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (Tumor Marker
Control/ TMC), в вариантах исполнения: Вариант 3» - вид сзади.

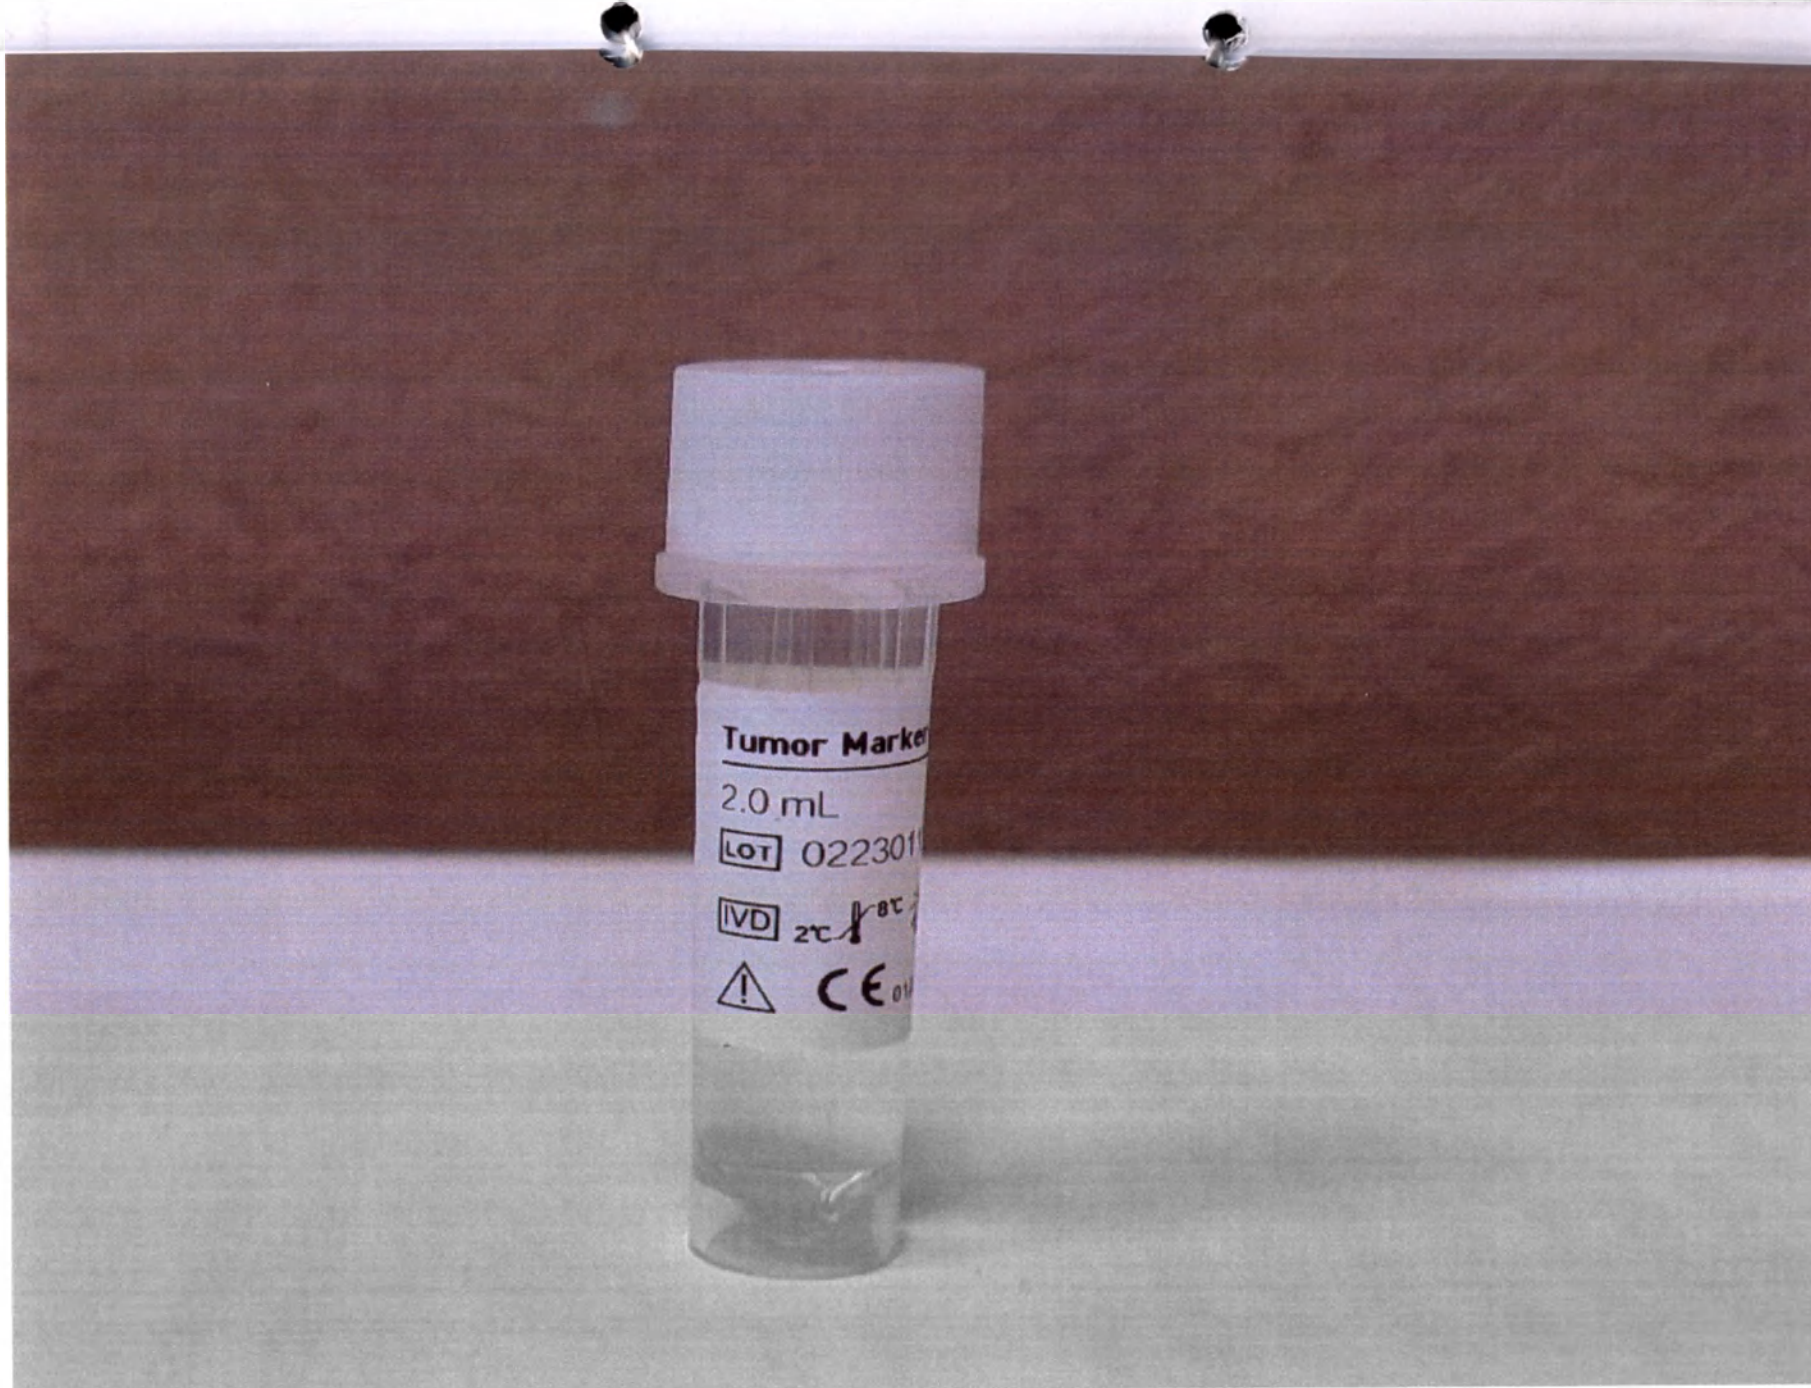

Пробирка содержащая «Материал контрольный 3 (Level 3)» - сторона 1.

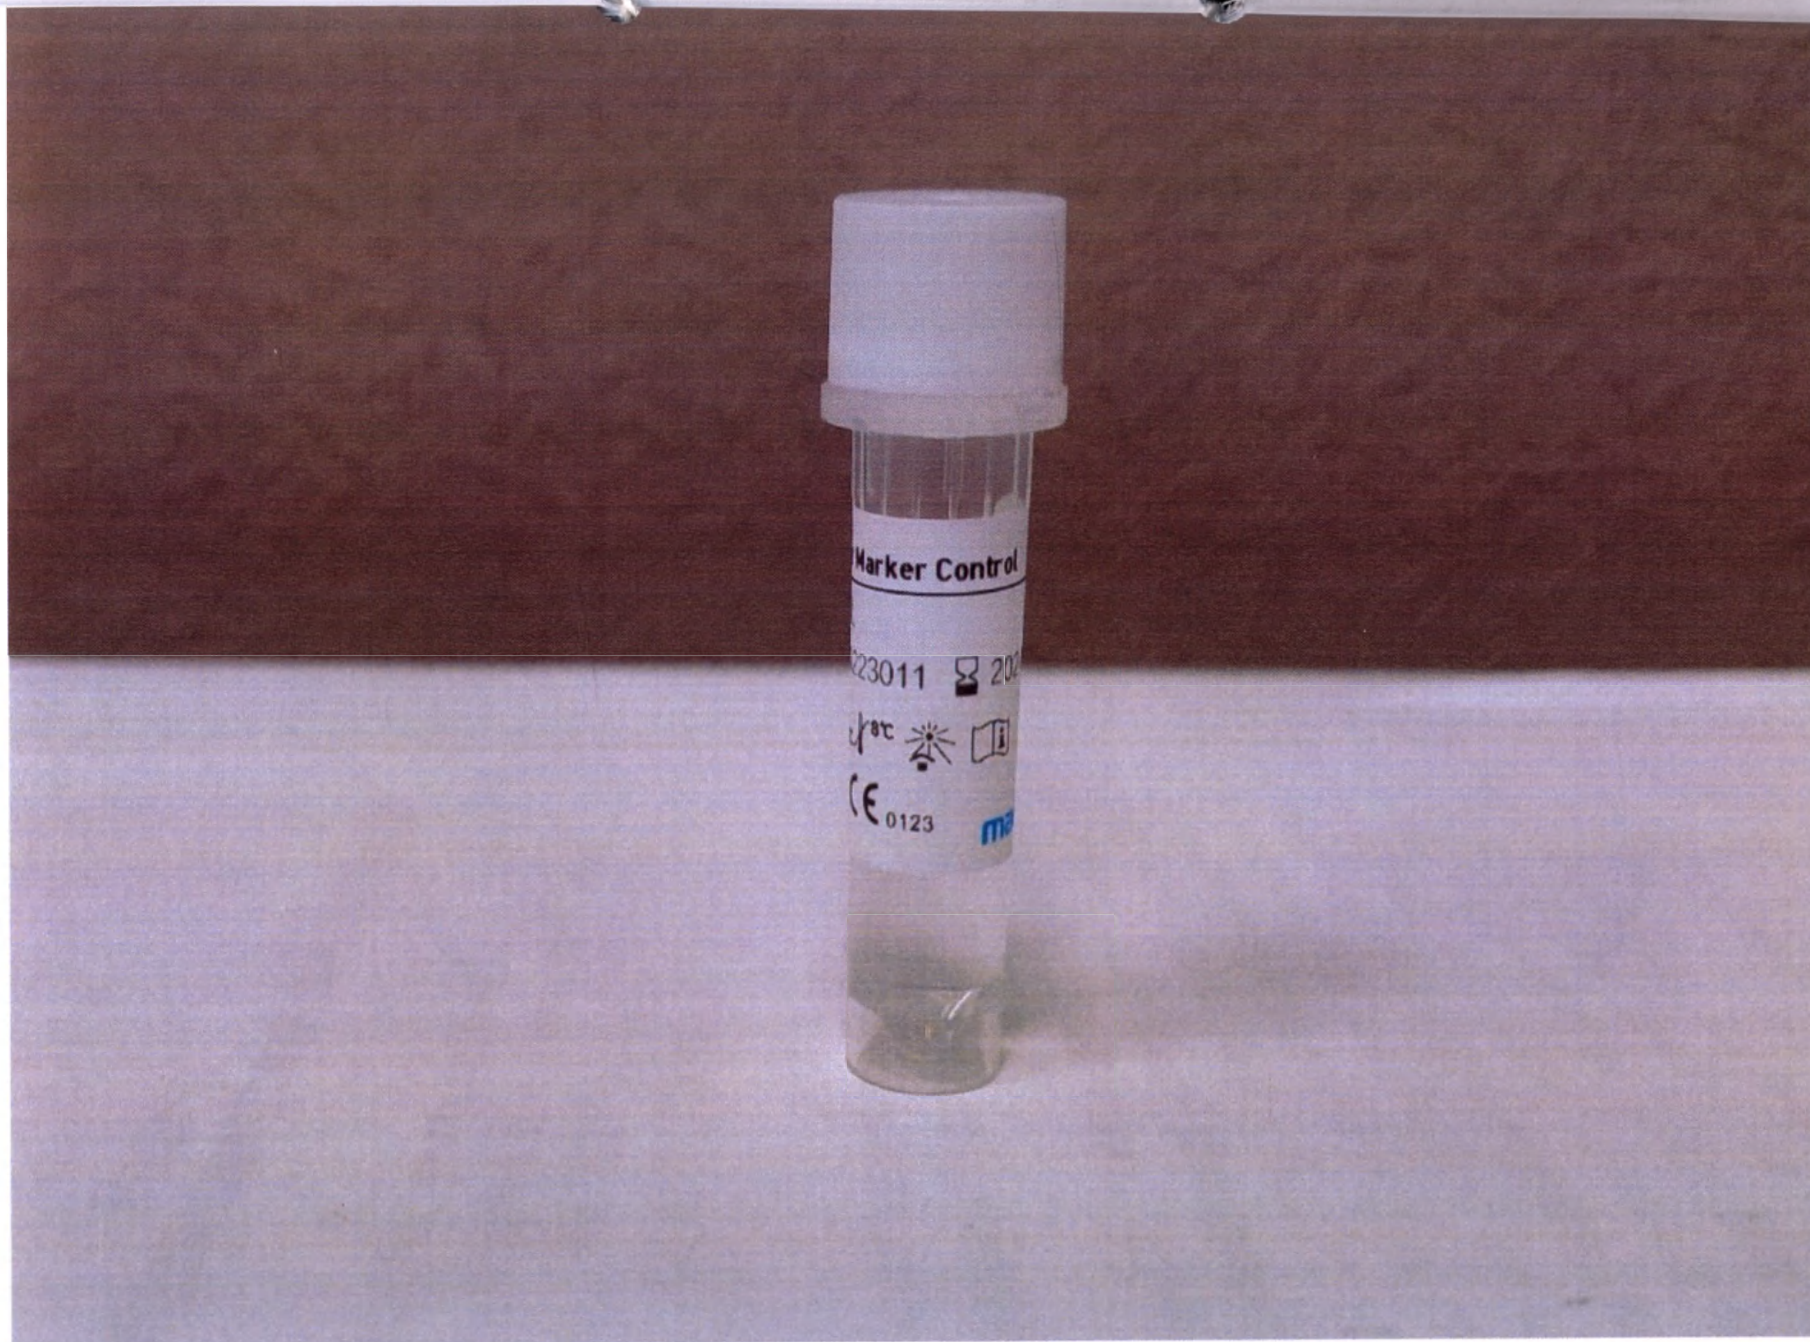

Пробирка содержащая «Материал контрольный 3 (Level 3)» - сторона 2.

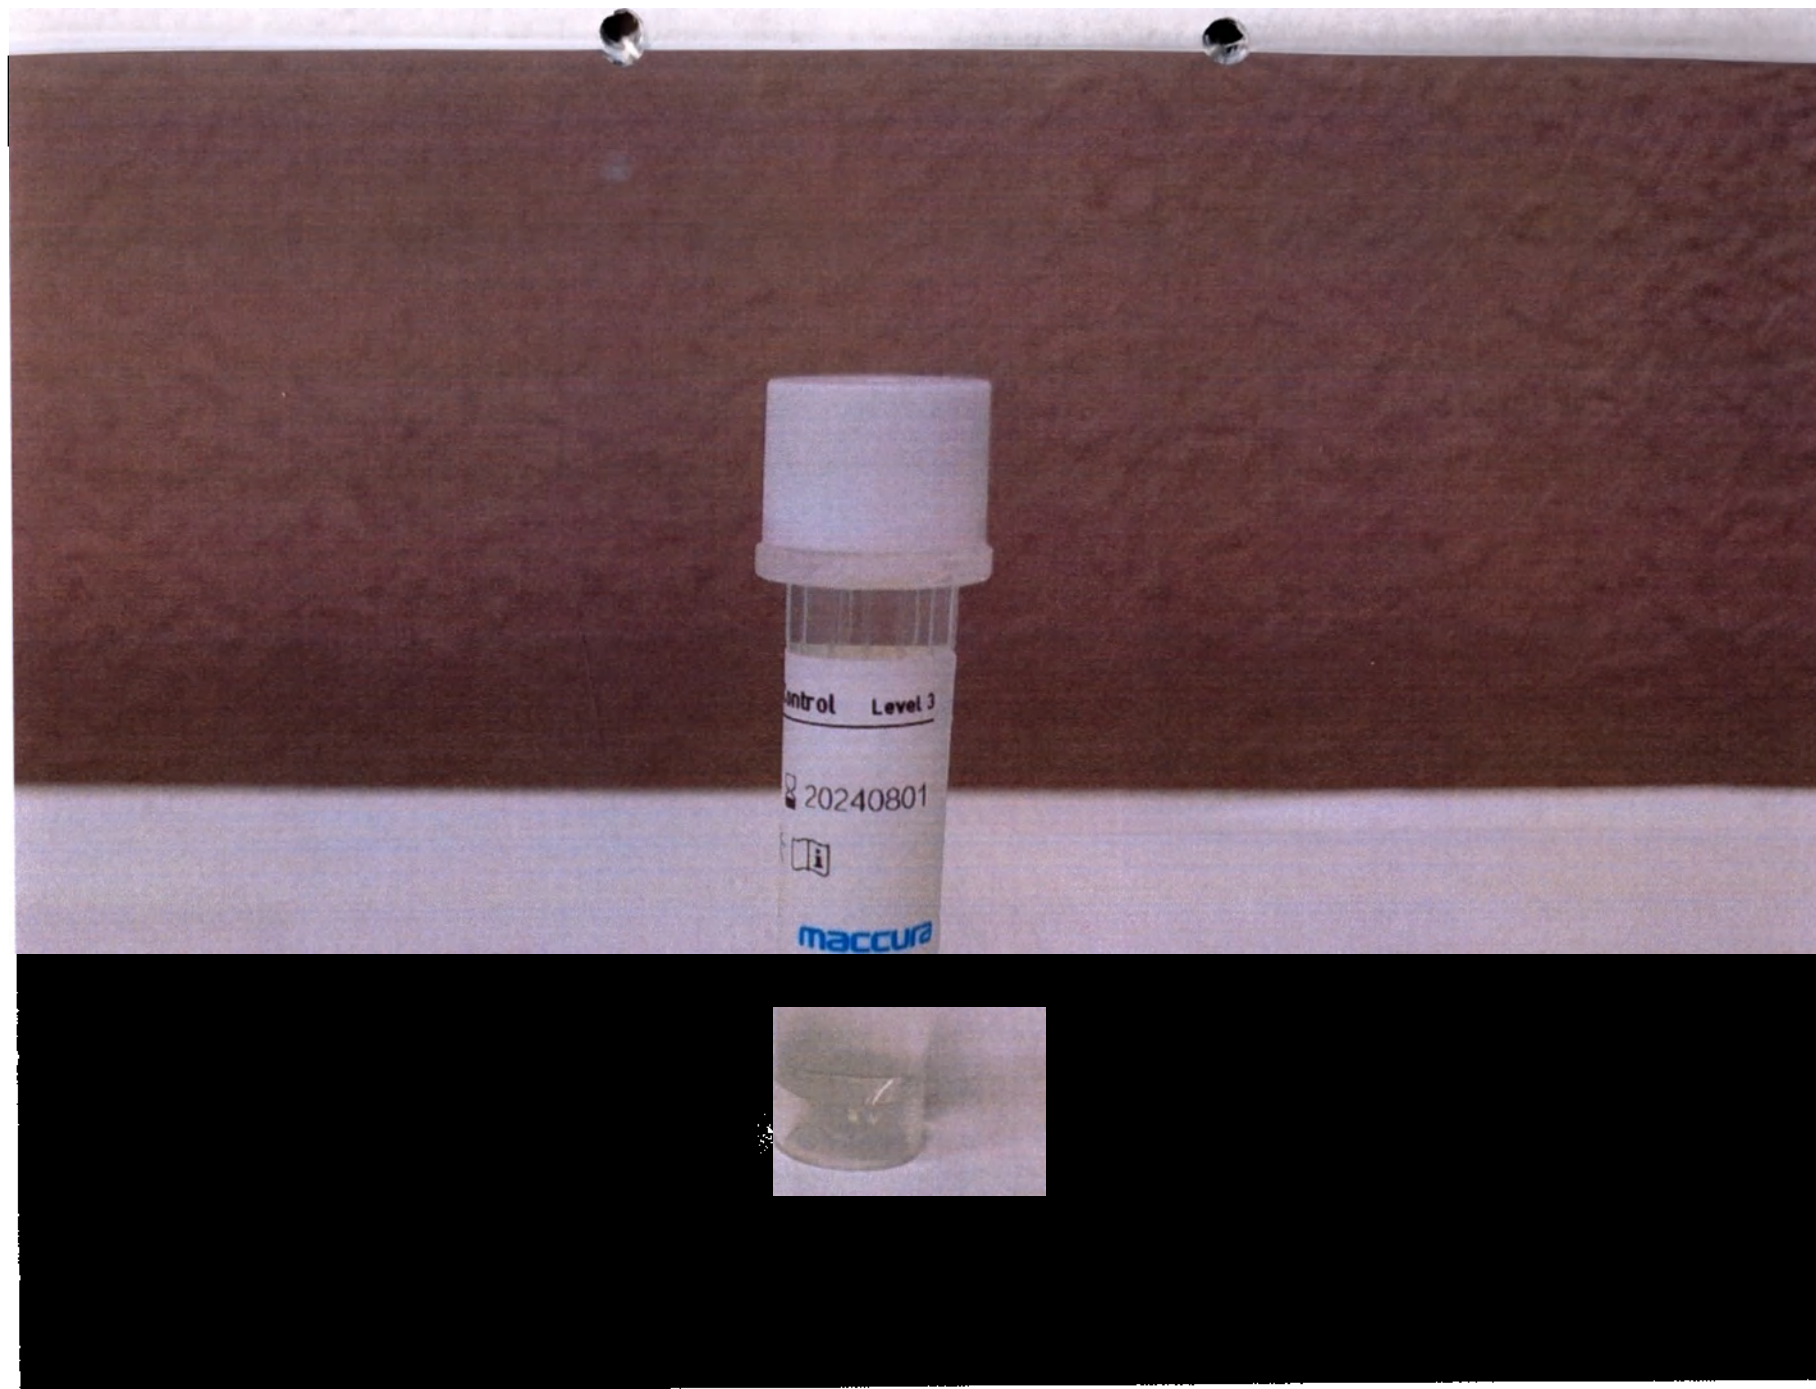

Пробирка содержащая «Материал контрольный 3 (Level 3)» - сторона 3.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 30 листов

Р.К. Мелконьянц
Директор ООО «Эвопром»