


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Видеомонитор цифровой Vathin для эндоскопии



Общий вид Видеомонитора цифрового DVM-B1 в потребительской упаковке

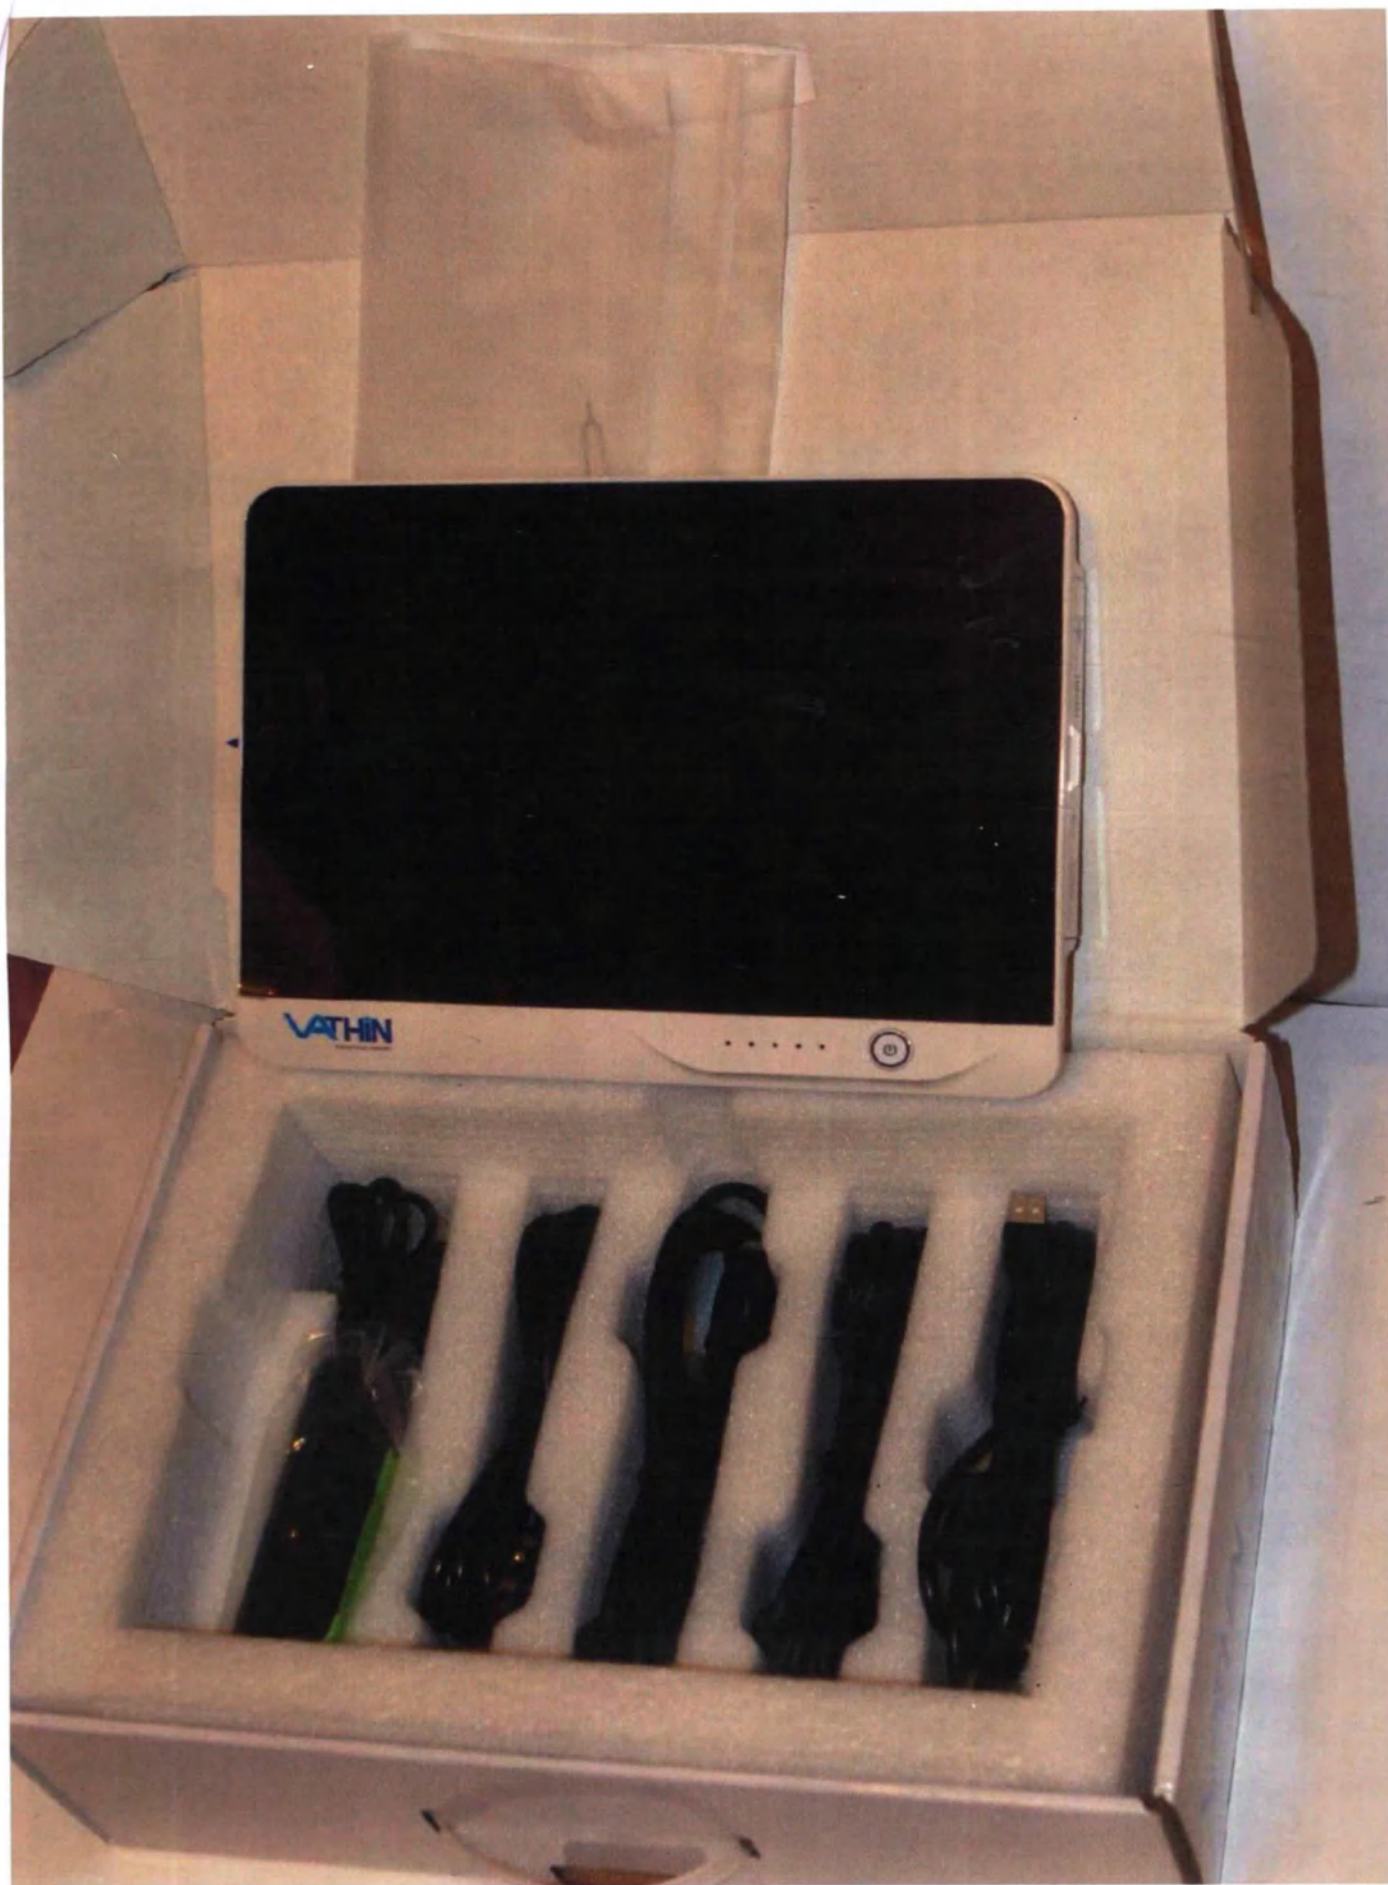

Видеомонитор цифровой DVM-B1, фронтальный вид



Видеомонитор цифровой DVM-B1, вид сбоку



Гнездо разъема для подсоединения эндоскопа к видеомонитору



Порт USB 2.0



Порты для кабелей HDMI-DVI, HDMI и USB-кабеля и адаптера питания



Порты для кабелей HDMI-DVI, HDMI и USB-кабеля и адаптера питания



Ключ для сброса настроек



USB-кабель



Кабель HDMI



Кабель монитора HDMI-DVI



Кабель питания



Адаптер питания

CE 0344

VATHIN Vathin
Medical
Value Your Health

Instruction for Use

Vathin® Digital Video Monitor

DVM-B1



- ◆ For use by trained clinicians/physicians only.
- ◆ For in-hospital use.
- ◆ For use with Vathin endoscope.
- ◆ Before use, thoroughly review this manual.
- ◆ Please keep all instruction manuals in a safe, accessible place.
- ◆ Have any questions or comments about this manual, contact with Vathin Medical.

Hunan Vathin Medical Instrument Co. Ltd.

Version: A/3


Руководство по эксплуатации

Instructions for use
Digital Video Monitor DVM-B1



VATHIN
Value Your Health

RU: Руководство по эксплуатации многоязычное
EN: English Operating Instructions
NO: Norsk brukerveiledning
DE: Deutsche Bedienungsanleitung
FR: Français notice d'usage
PT: Manual de instruções
ES: Instrucciones de uso
IT: Istruzioni d'uso
NL: Gebruiksaanwijzing
FI: Käyttöohje
SV: Användningsanvisning
HU: Használati utasítás
CZ: Návod k obsluze
SK: Návod k obsluze
PL: Instrukcja obsługi
TR: Kullanma kılavuzu
UK: Інструкція з експлуатації
UA: Інструкція з експлуатації
BY: Інструкцыя па эксплуатацыі
BG: Инструкция за употреба
RO: Manual de utilizare
HR: Upute za uporabu
SI: Uporabna priročila
LT: Naudojimo instrukcija
LV: Lietošanas instrukcija
EE: Kasutusjuhend
RU: Руководство по эксплуатации
EN: English Operating Instructions
NO: Norsk brukerveiledning
DE: Deutsche Bedienungsanleitung
FR: Français notice d'usage
PT: Manual de instruções
ES: Instrucciones de uso
IT: Istruzioni d'uso
NL: Gebruiksaanwijzing
FI: Käyttöohje
SV: Användningsanvisning
HU: Használati utasítás
CZ: Návod k obsluze
SK: Návod k obsluze
PL: Instrukcja obsługi
TR: Kullanma kılavuzu
UK: Інструкція з експлуатації
UA: Інструкція з експлуатації
BY: Інструкцыя па эксплуатацыі
BG: Инструкция за употреба
RO: Manual de utilizare
HR: Upute za uporabu
SI: Uporabna priročila
LT: Naudojimo instrukcija
LV: Lietošanas instrukcija
EE: Kasutusjuhend



Hunan Vathin Medical Instrument Co., Ltd.
1/F, Building 12, Innovation and Entrepreneurship Service Center
No 8 Changyi west road, Auhua Economic Development Zone,
Xiangtan, Hunan, China

The Vathin logo is registered trademark of Vathin.
All rights reserved Vathin.

Руководство по эксплуатации на CD-диске многоязычное

VATHIN
Value Your Health

Видеомонитор цифровой DVM-B1 в потребительской упаковке

VATHIN
Video Your Health

Видеомонитор цифровой Vathin для эндоскопии
Вариант исполнения: Видеомонитор цифровой DVM-B1

Вес брутто: 4.35 кг Количество: 1 штука




04.11.2020

SN

M2010073

REF

1990110070-B



Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов,
взрывоопасных и горючих материалов при температуре от -10°C до +40°C
 Hunan Vathin Medical Instrument Co., Ltd., («Хунань Ватин Медикал
Инструмент Ко., Лтд.»)
1/F, Building 12, Innovation and Entrepreneurship Service Center, No 9 Chuanqi
West Road, Jinhua Economic Development Zone, 411100 Xiangtan, Hunan, China
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «СтериСкоп», 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-
кт Ленинградский, д. 7, стр. 1, помещ. 1/2

РУ № _____



Видеомонитор цифровой DVM-B1 на тележке с кронштейном Trolley (with pylon)

SIZE: 80X80X20 CM

Тележка с кронштейном Trolly (with pylon)
 Модель: MET-A2
 Вес брутто: 10.58 кг.

04.11.2020 SN M 2010073

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от -10°C до +40°C

Hunan Vathin Medical Instrument Co., Ltd.
 («Хуань Ватин Медикал Инструментс Ко., Лтд.»)

1/F, Building 12, Innovation and Entrepreneurship Service Center, No 9 Chuang West Road, Huzhou Economic Development Zone, 411100 Xiangtan, Hunan, China

Уполномоченный представитель на территории РФ:
 ООО «СтериСкоп», 125040, Россия, г. Москва, вн.тер. муниципального округа Беговой, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, помещ. 1/2

РУ № _____

Тележка с кронштейном Trolly (with pylon)
 в транспортной упаковке с маркировкой на территории РФ



Кронштейн Pylon



Основание тележки




Колеса поворотные с тормозом




Трубы стойки раздвижной



Корзина для хранения

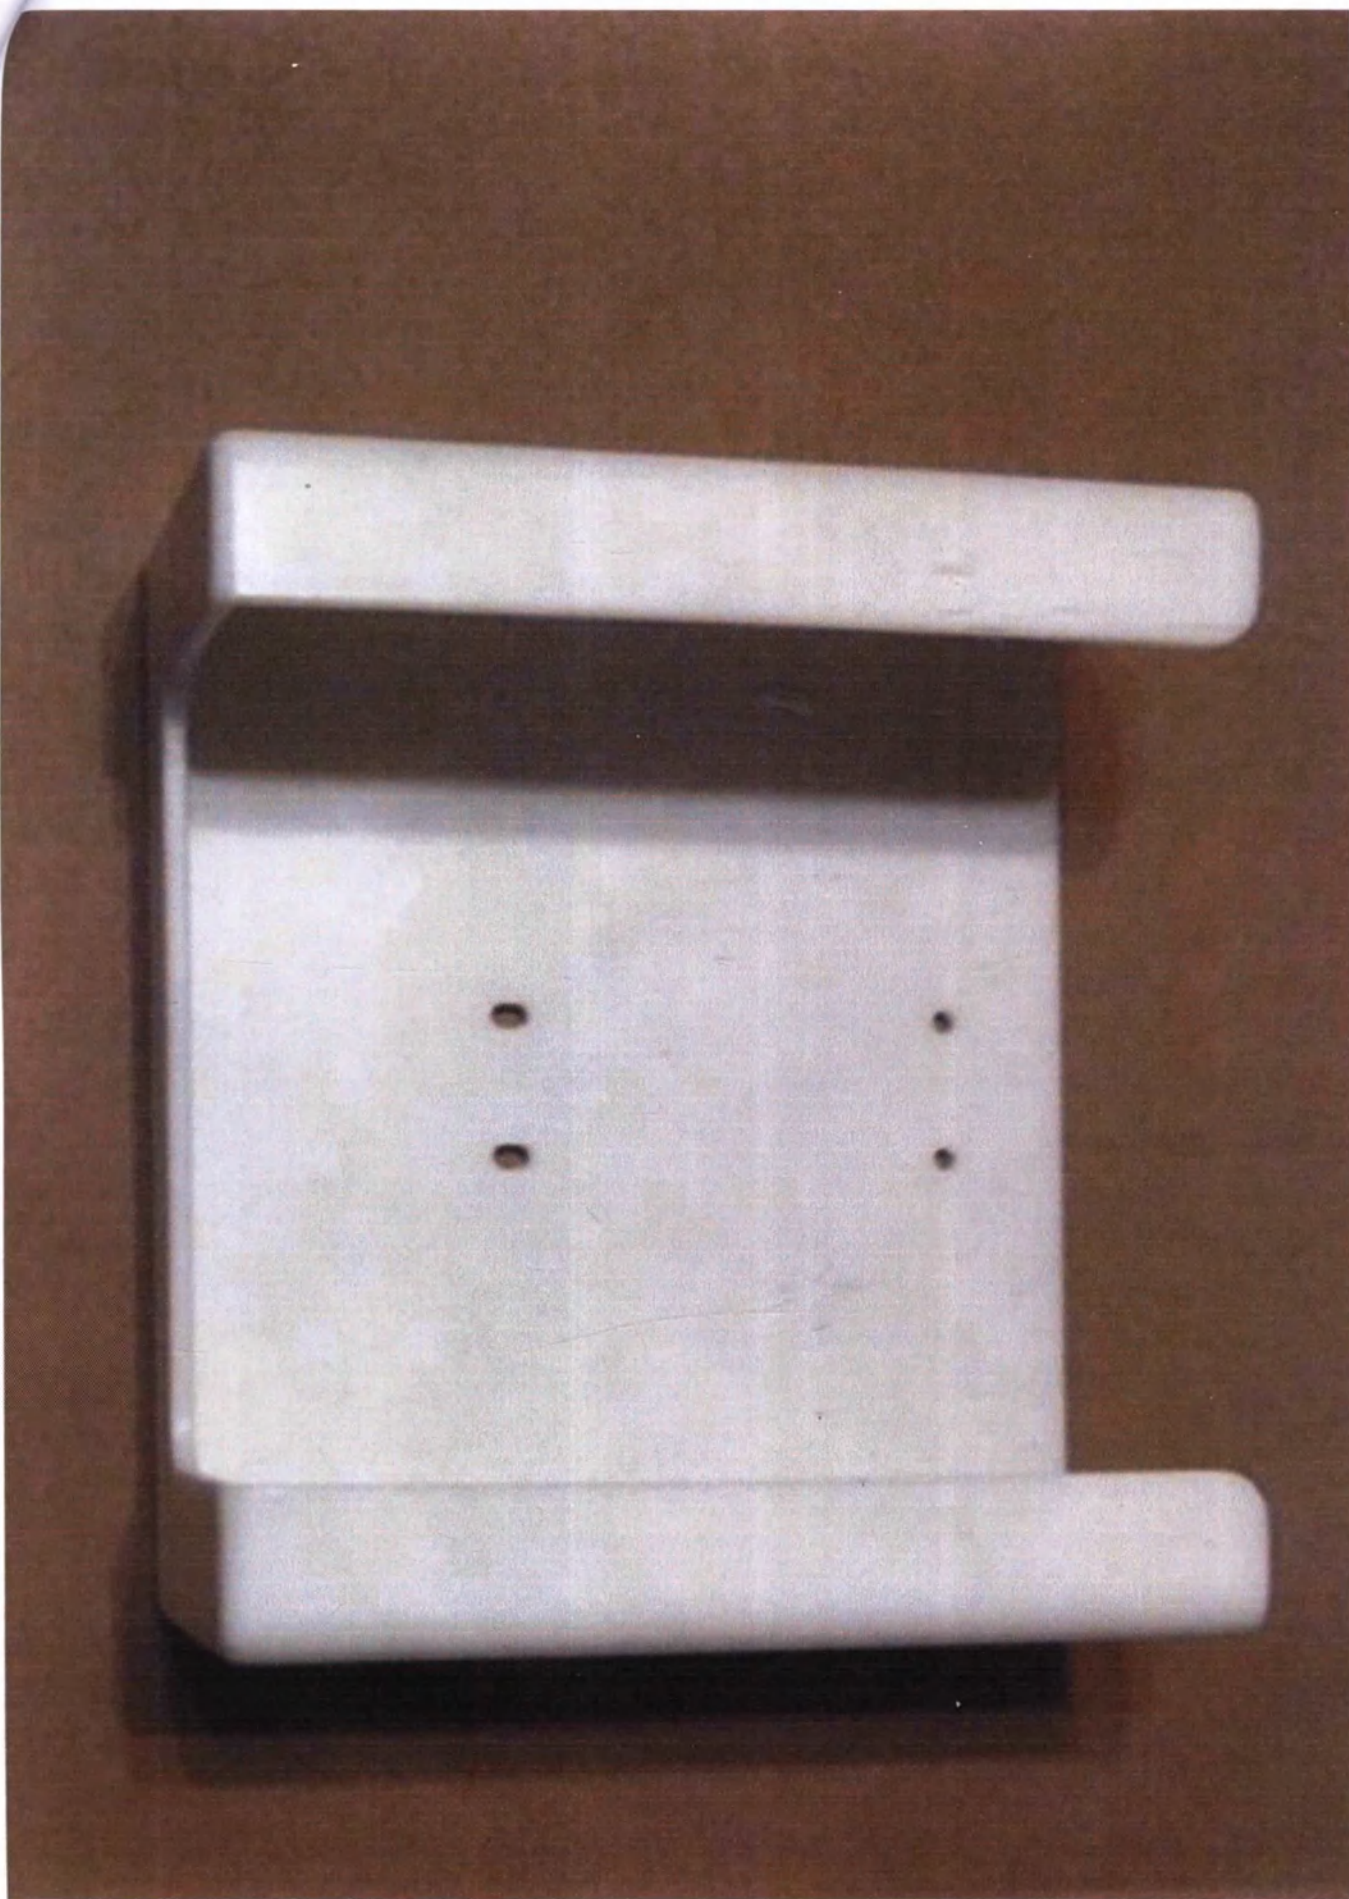

Держатель для видеомонитора

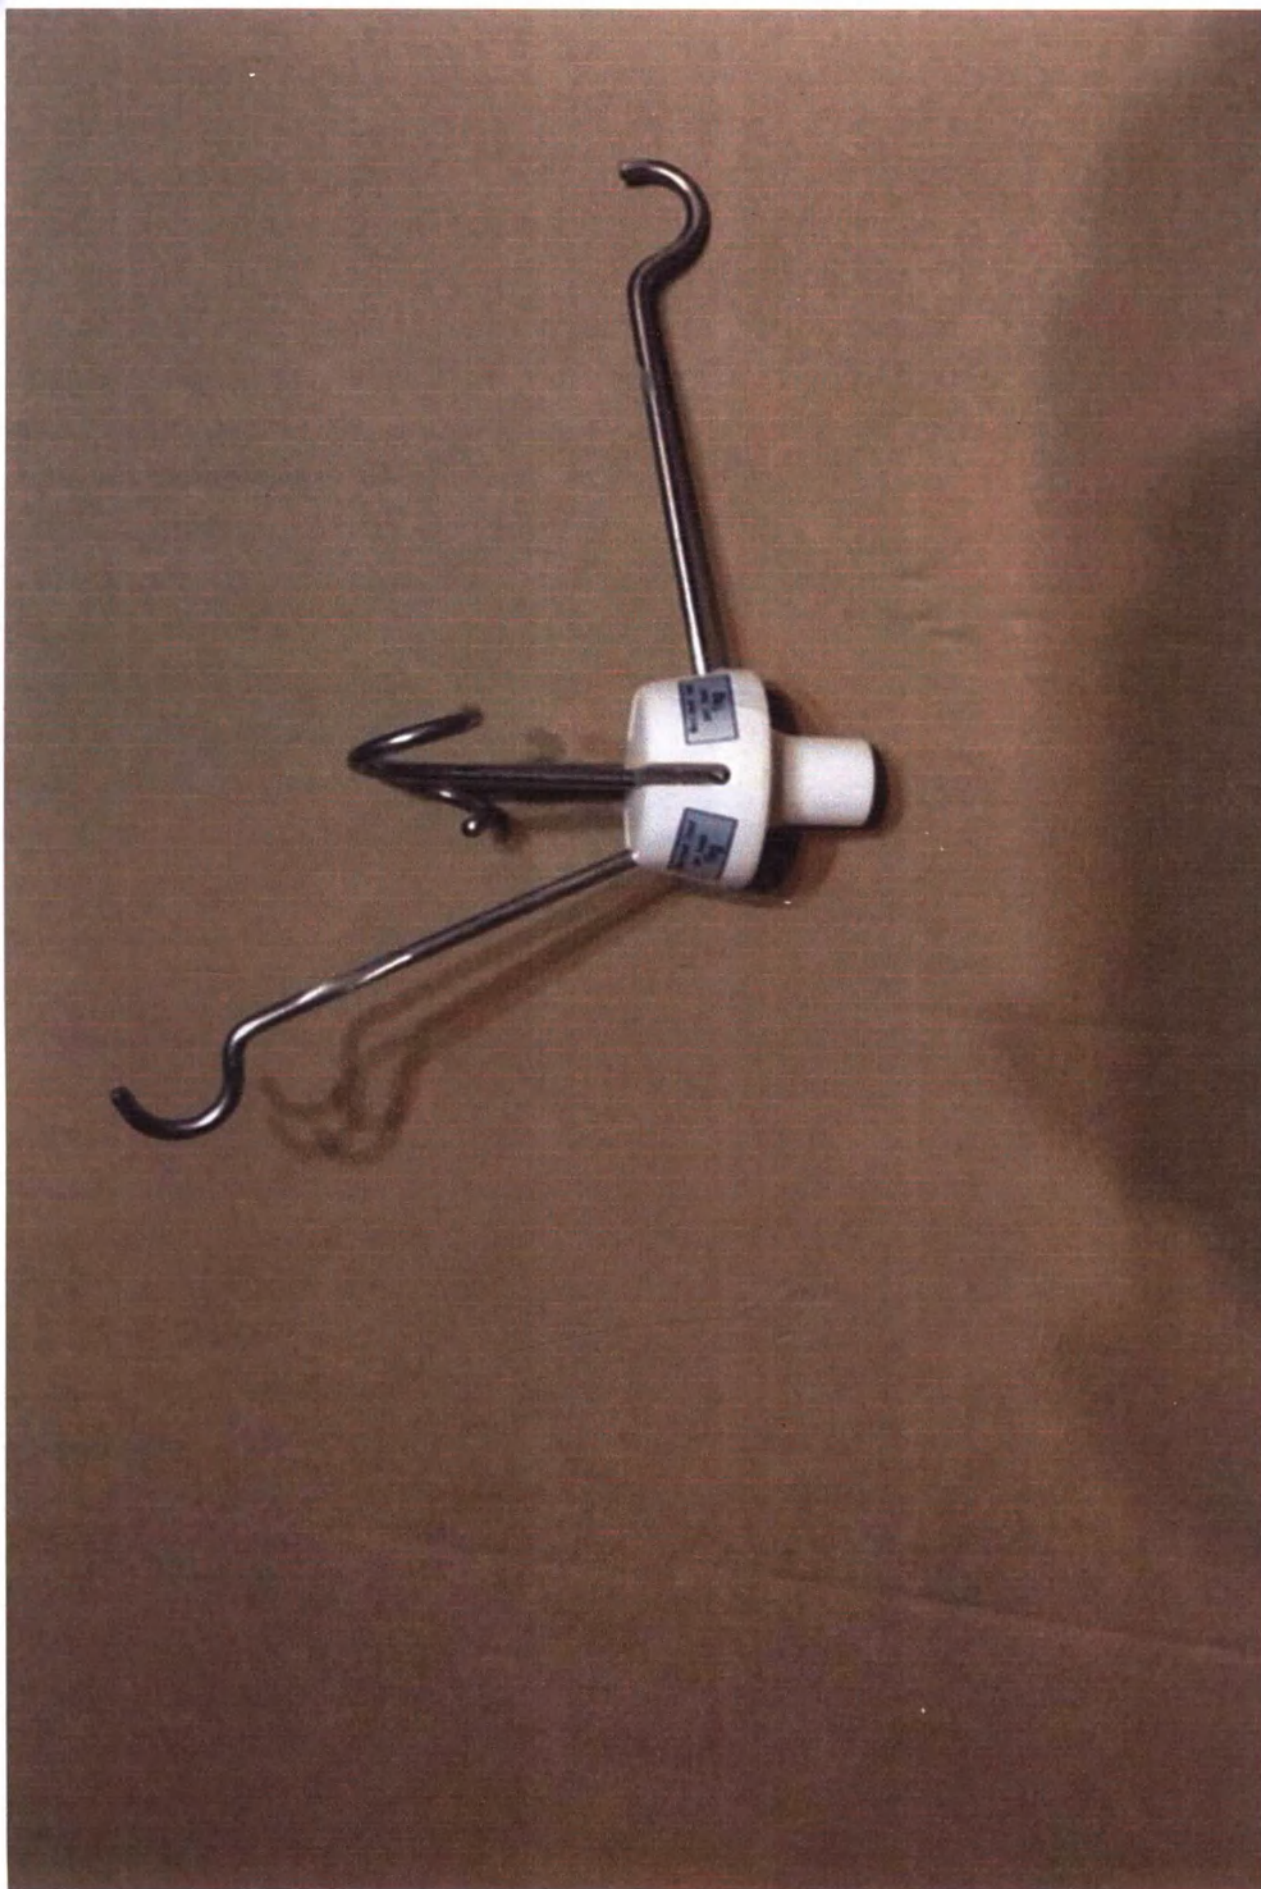

Подвес для эндоскопа в стерилизационной упаковке



Держатель для адаптера




Крепеж для основания стойки с 4 болтами



Винты торцевые с шестигранной головкой М4* 10 – 8 шт




Ключи торцевые шестигранные

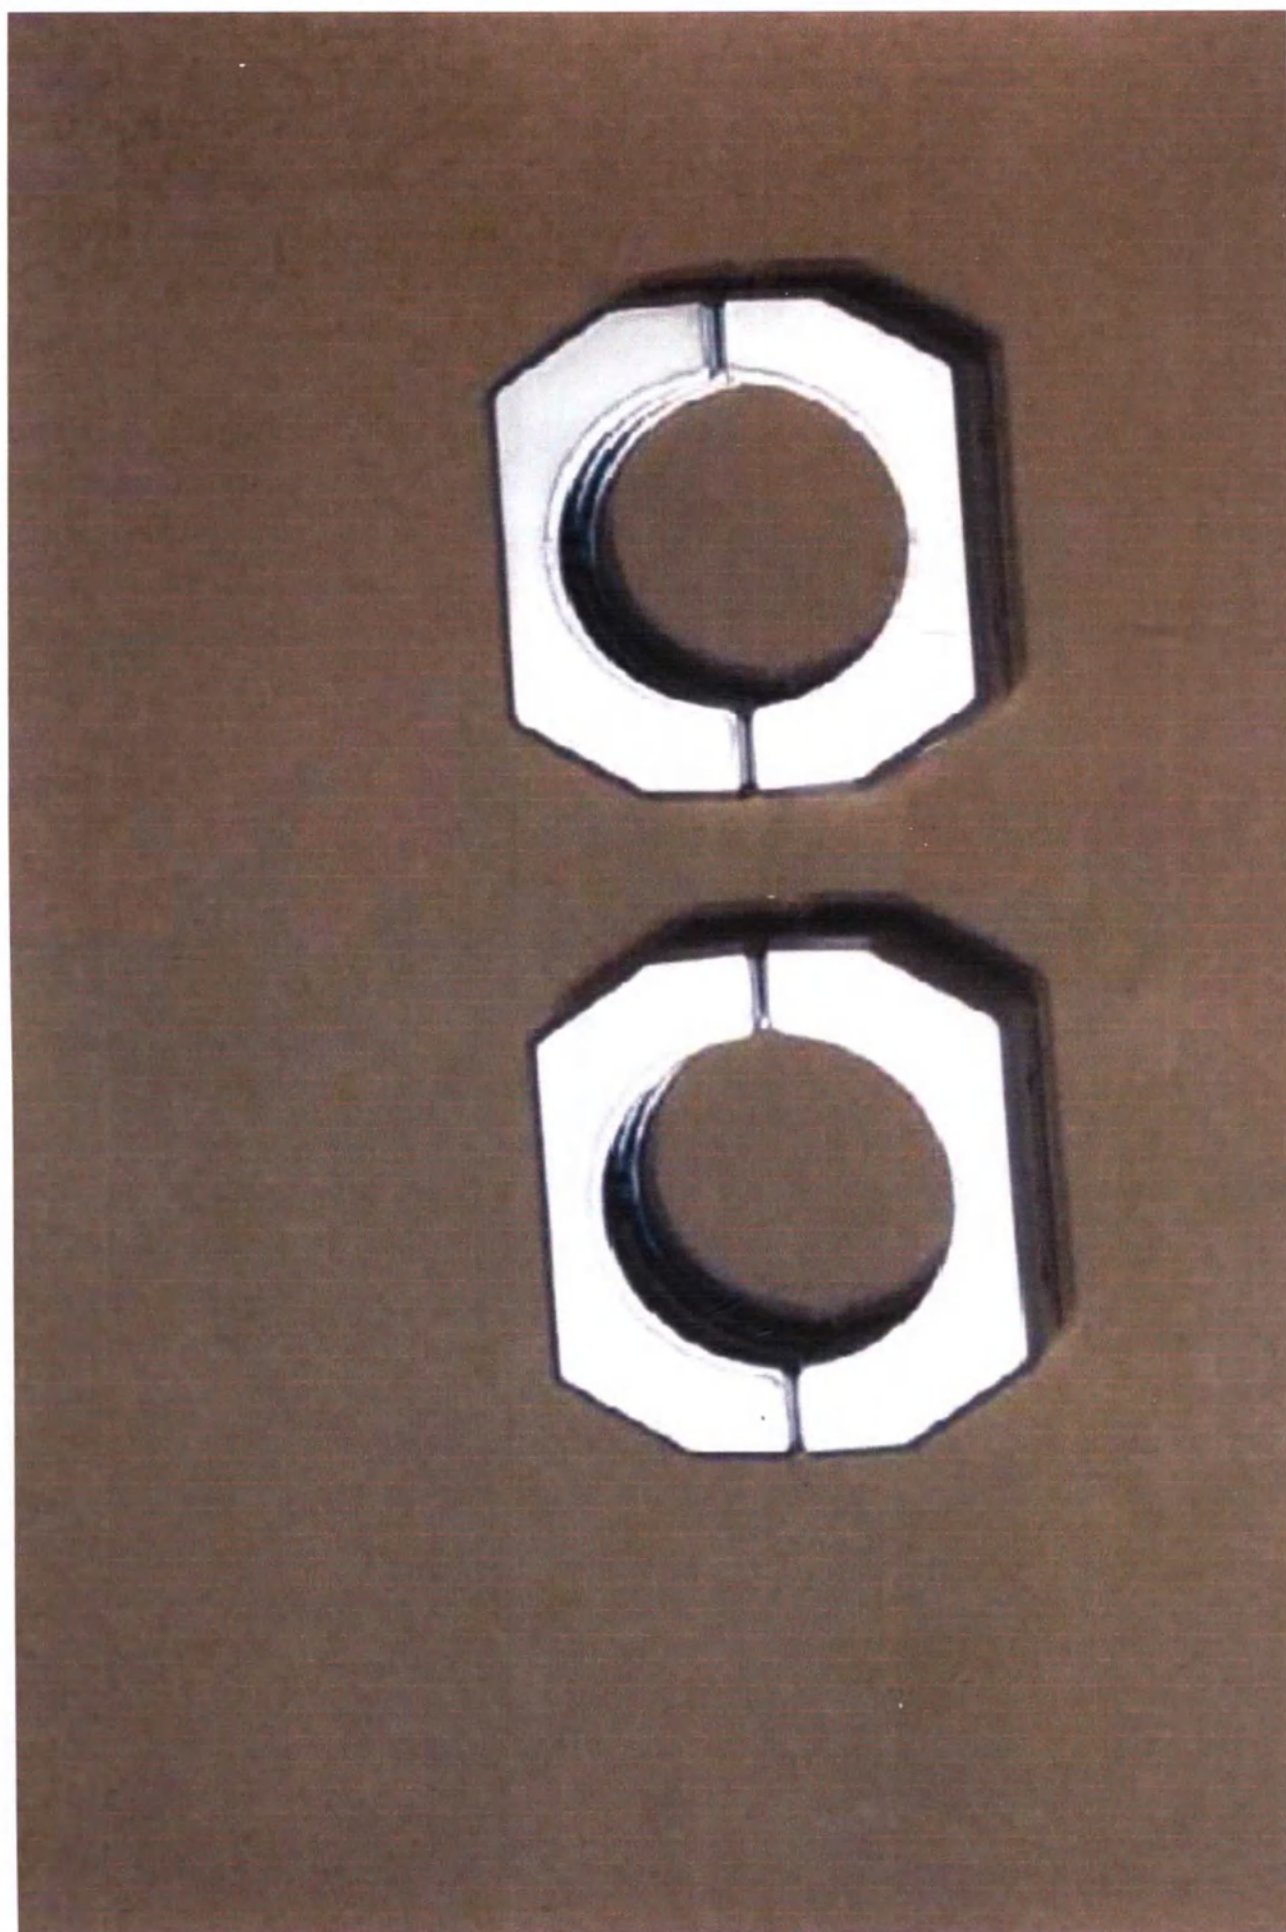


Фиксаторы для стойки



Ручка для тележки

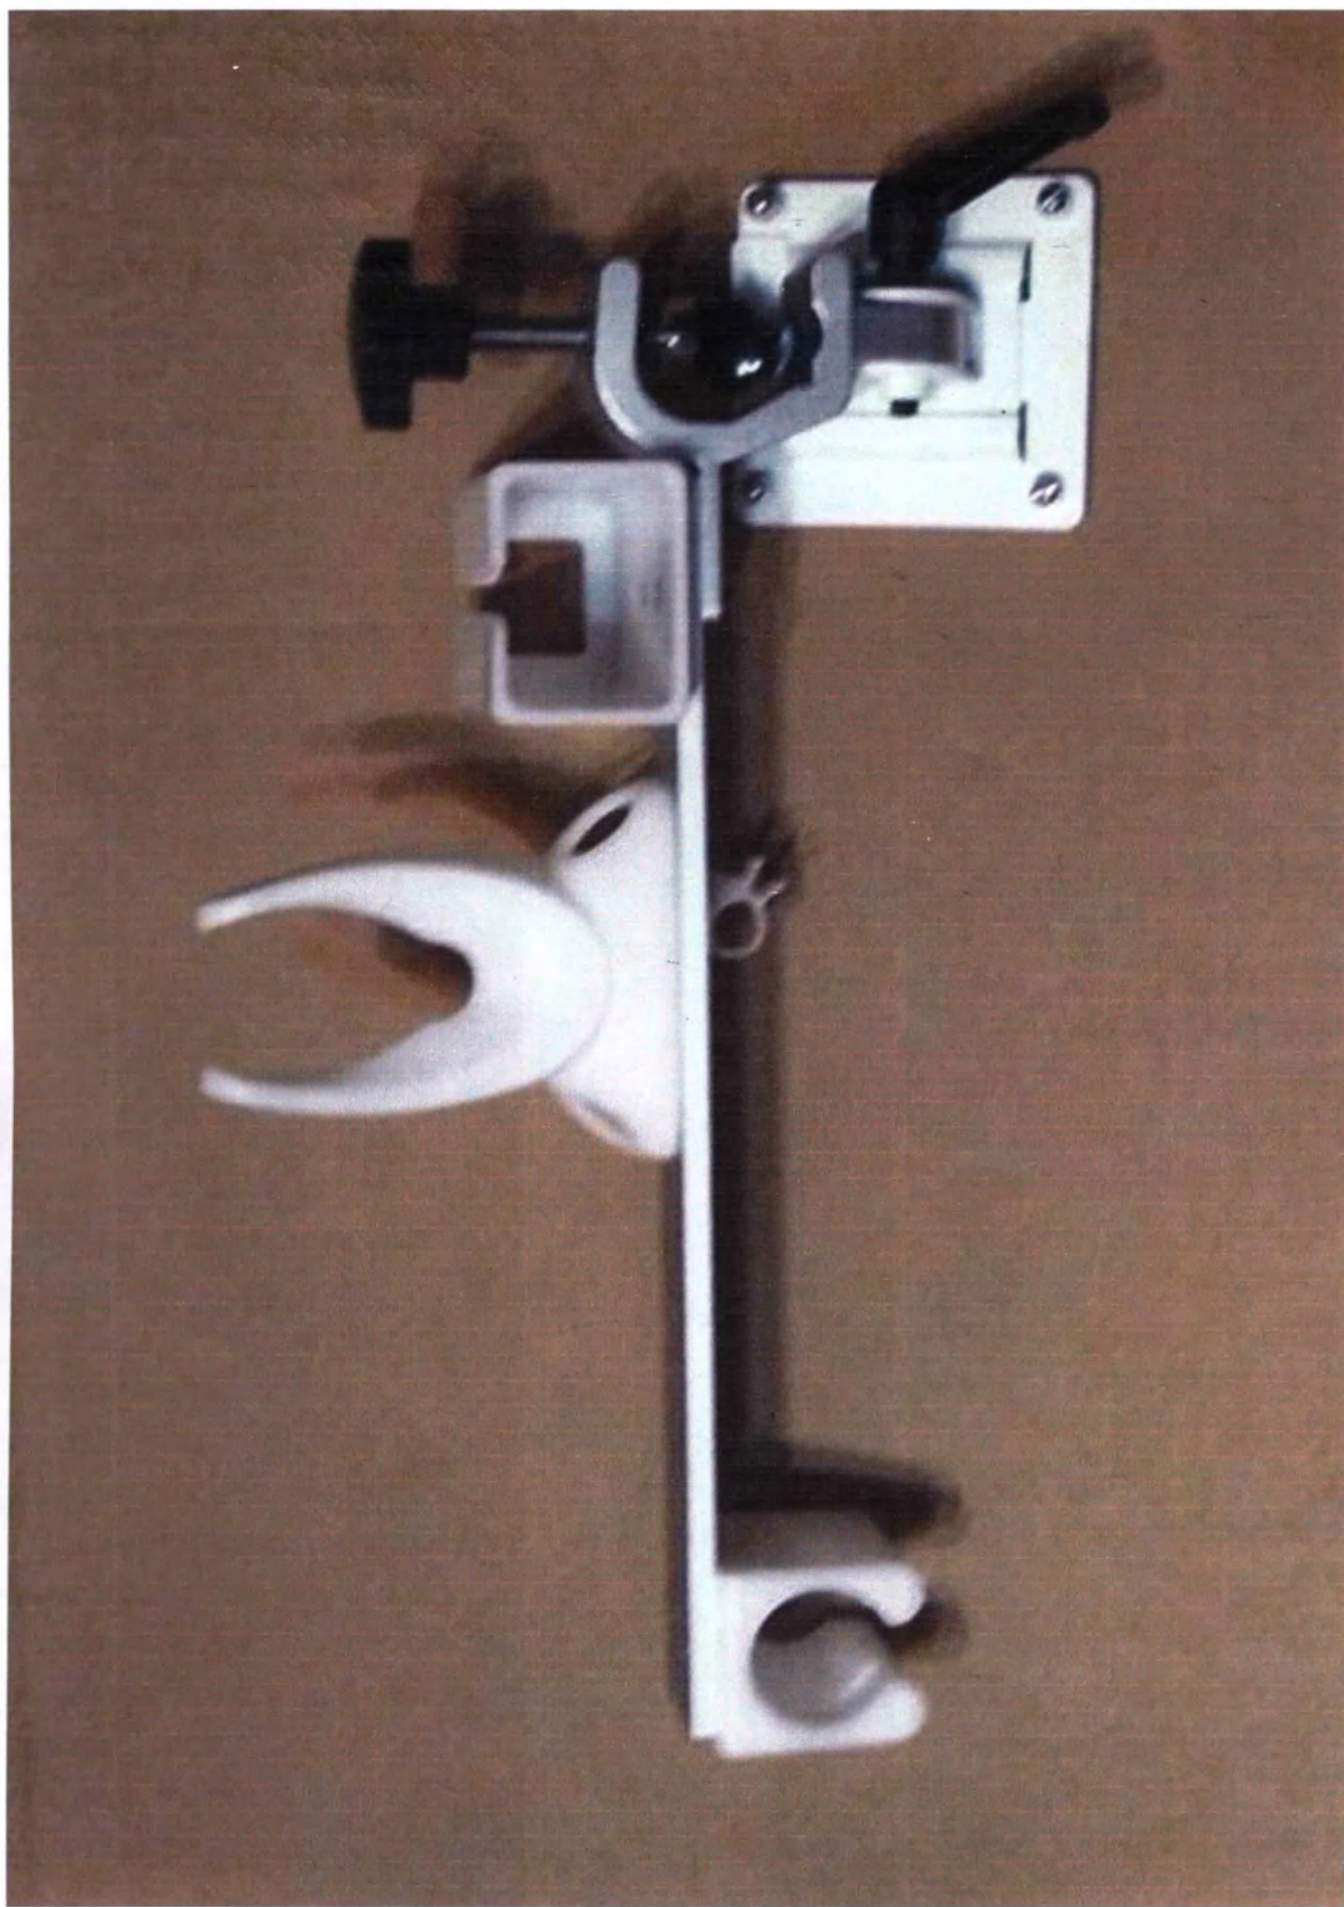

Кронштейн Рulon

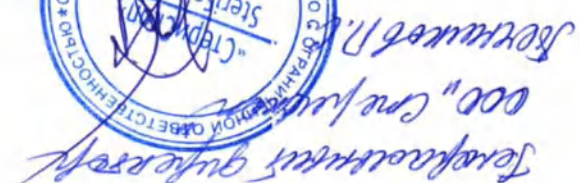

Степаново наследство
36 оуменс




 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU