

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China



Общий вид МИ «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена CA 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Masscura i (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена CA 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку
«Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена
CA 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura
i (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司
住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号
电话: +86 28 8782 6777
传真: +86 28 8782 5783
邮编: 611731
邮箱: maccura@maccura.com




Maccura Biotechnology Co., Ltd.
Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731
Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86 28 8782 6777
Fax: +86 28 8782 5783
E-mail: maccura@maccura.com

www.maccura.com




Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку
«Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура і (СА 125
(CLIA)), набор на 200 тестов»

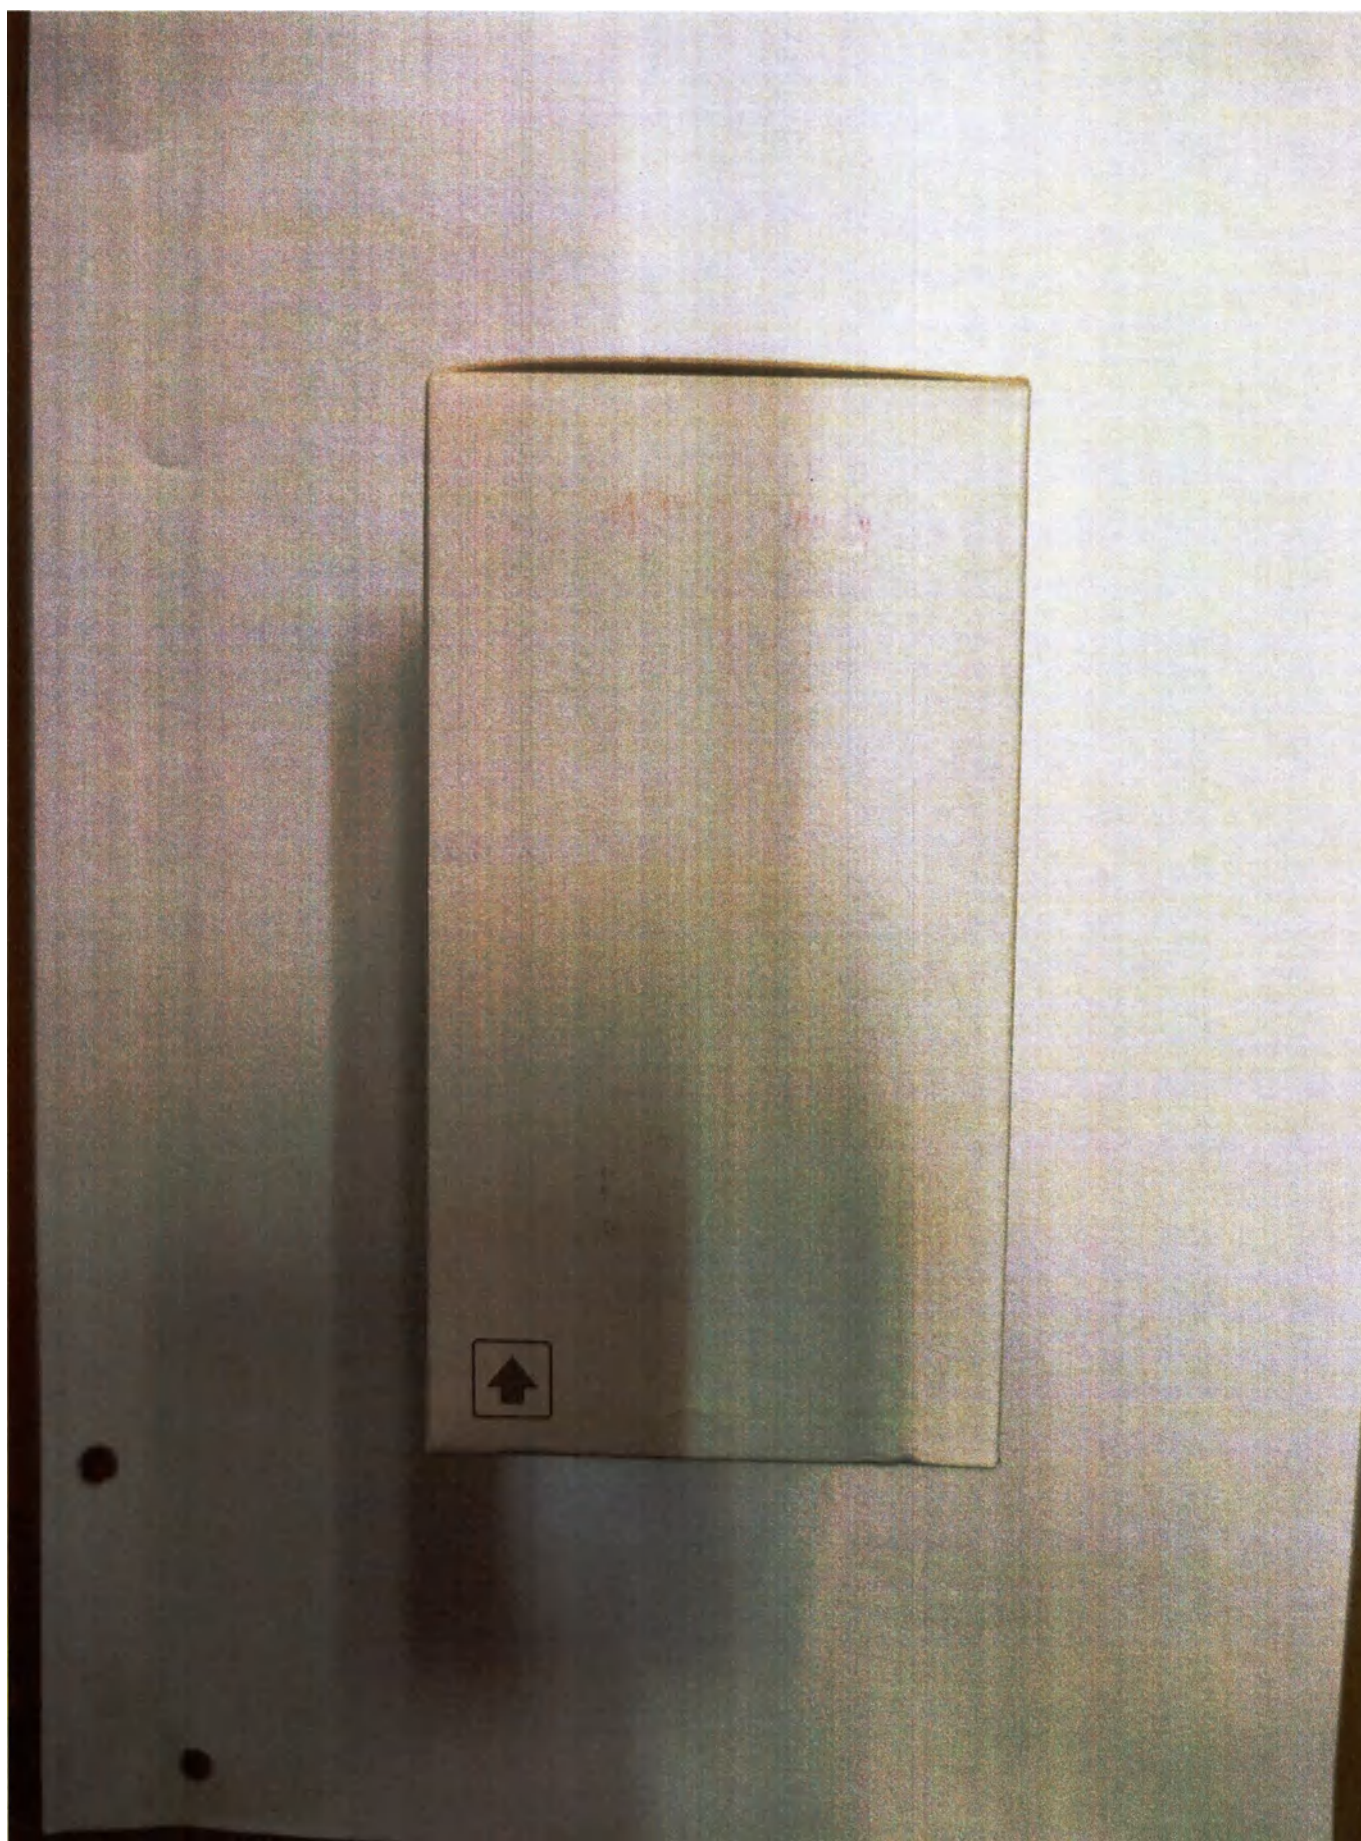


**Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку
«Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массига i (CA 125
(CLIA)), набор на 200 тестов»**




Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку
«Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена CA 125
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (CA 125
(CLIA)), набор на 200 тестов»

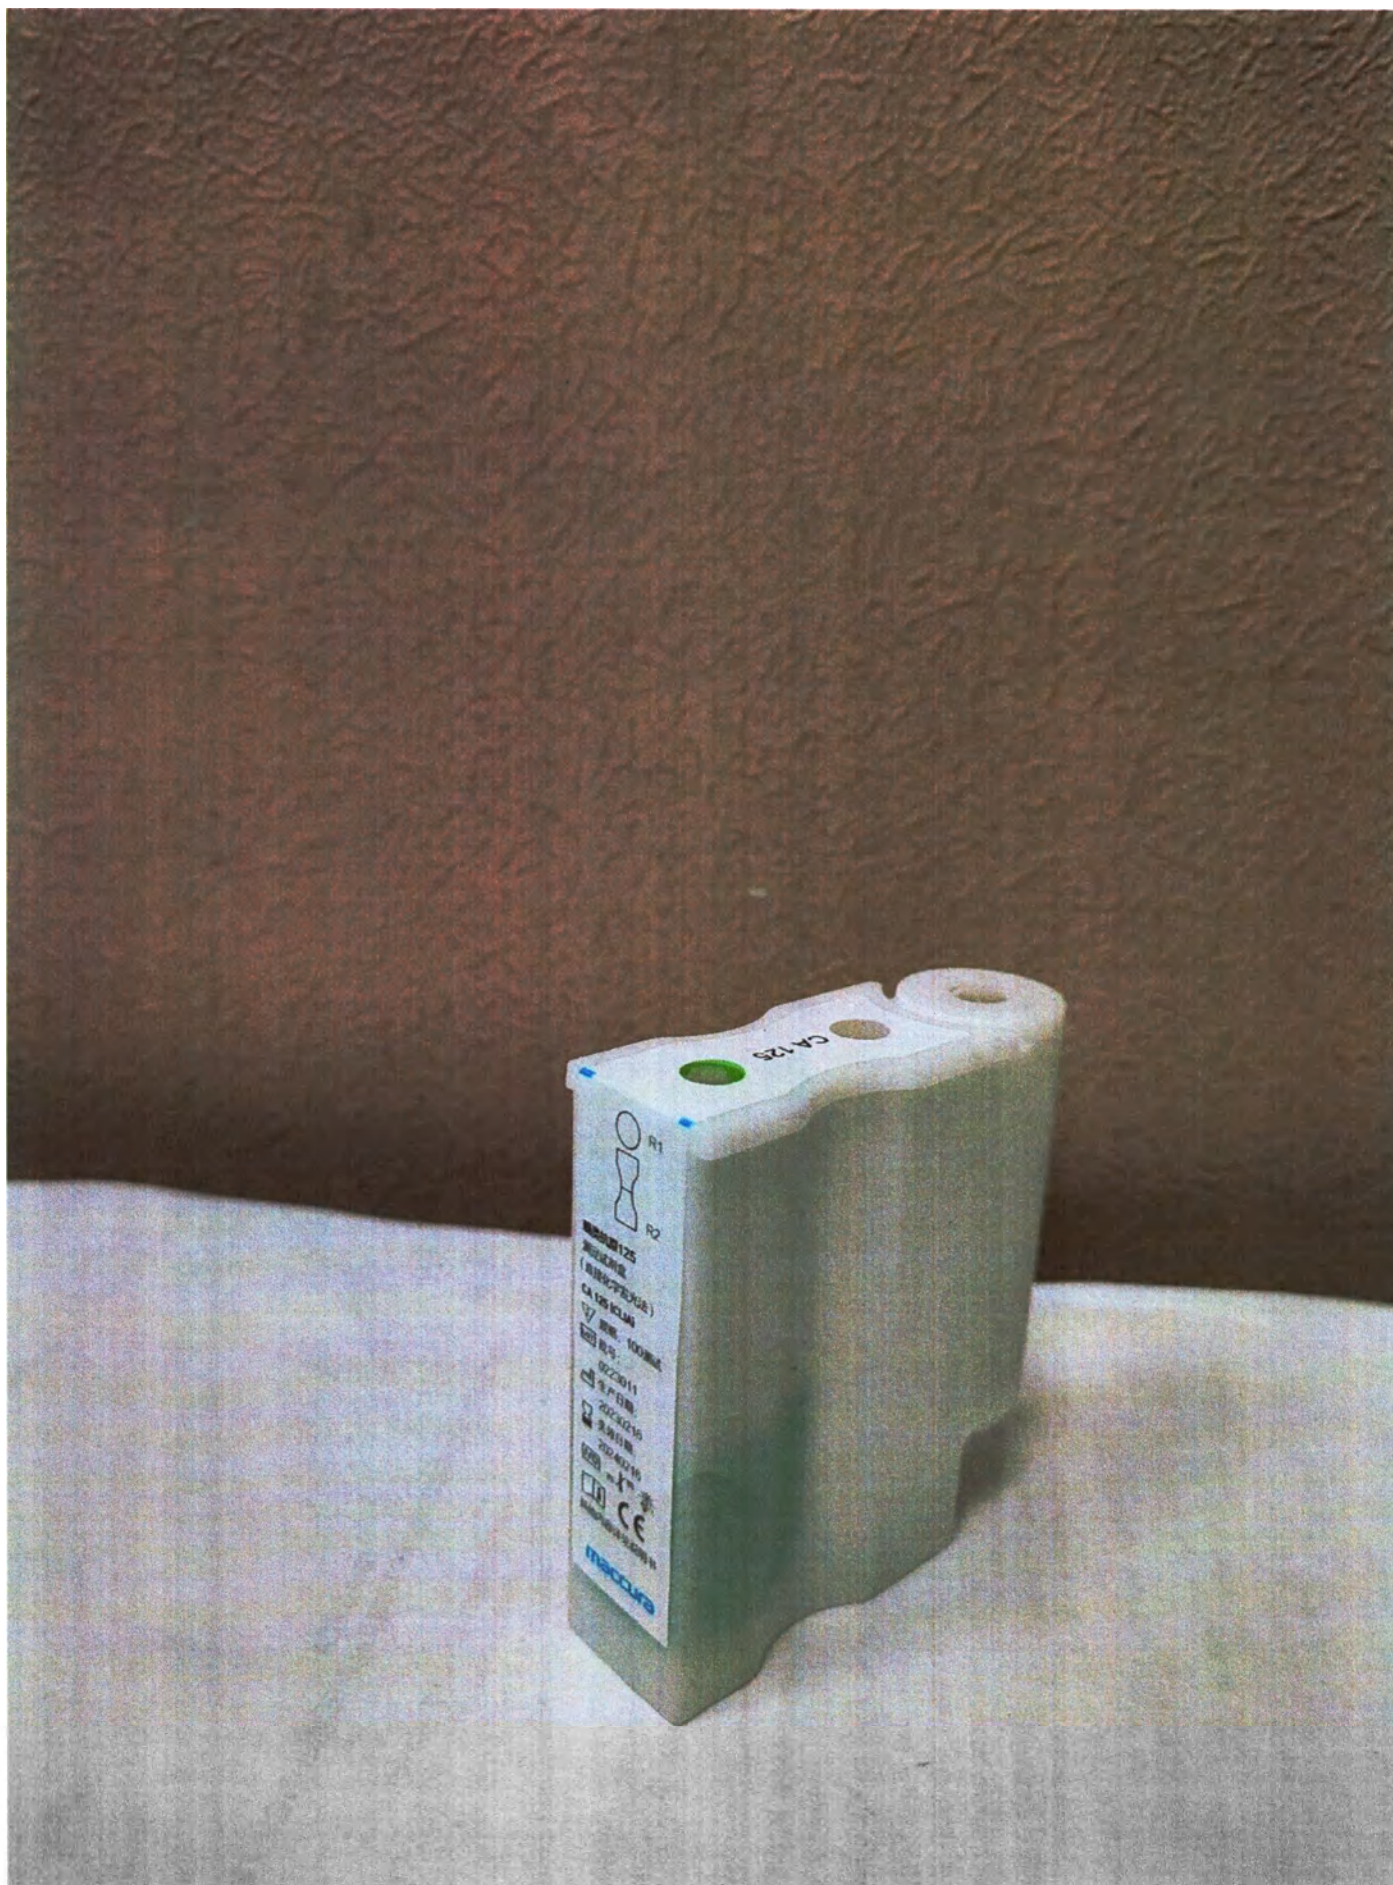

Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2 «Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена CA 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов»

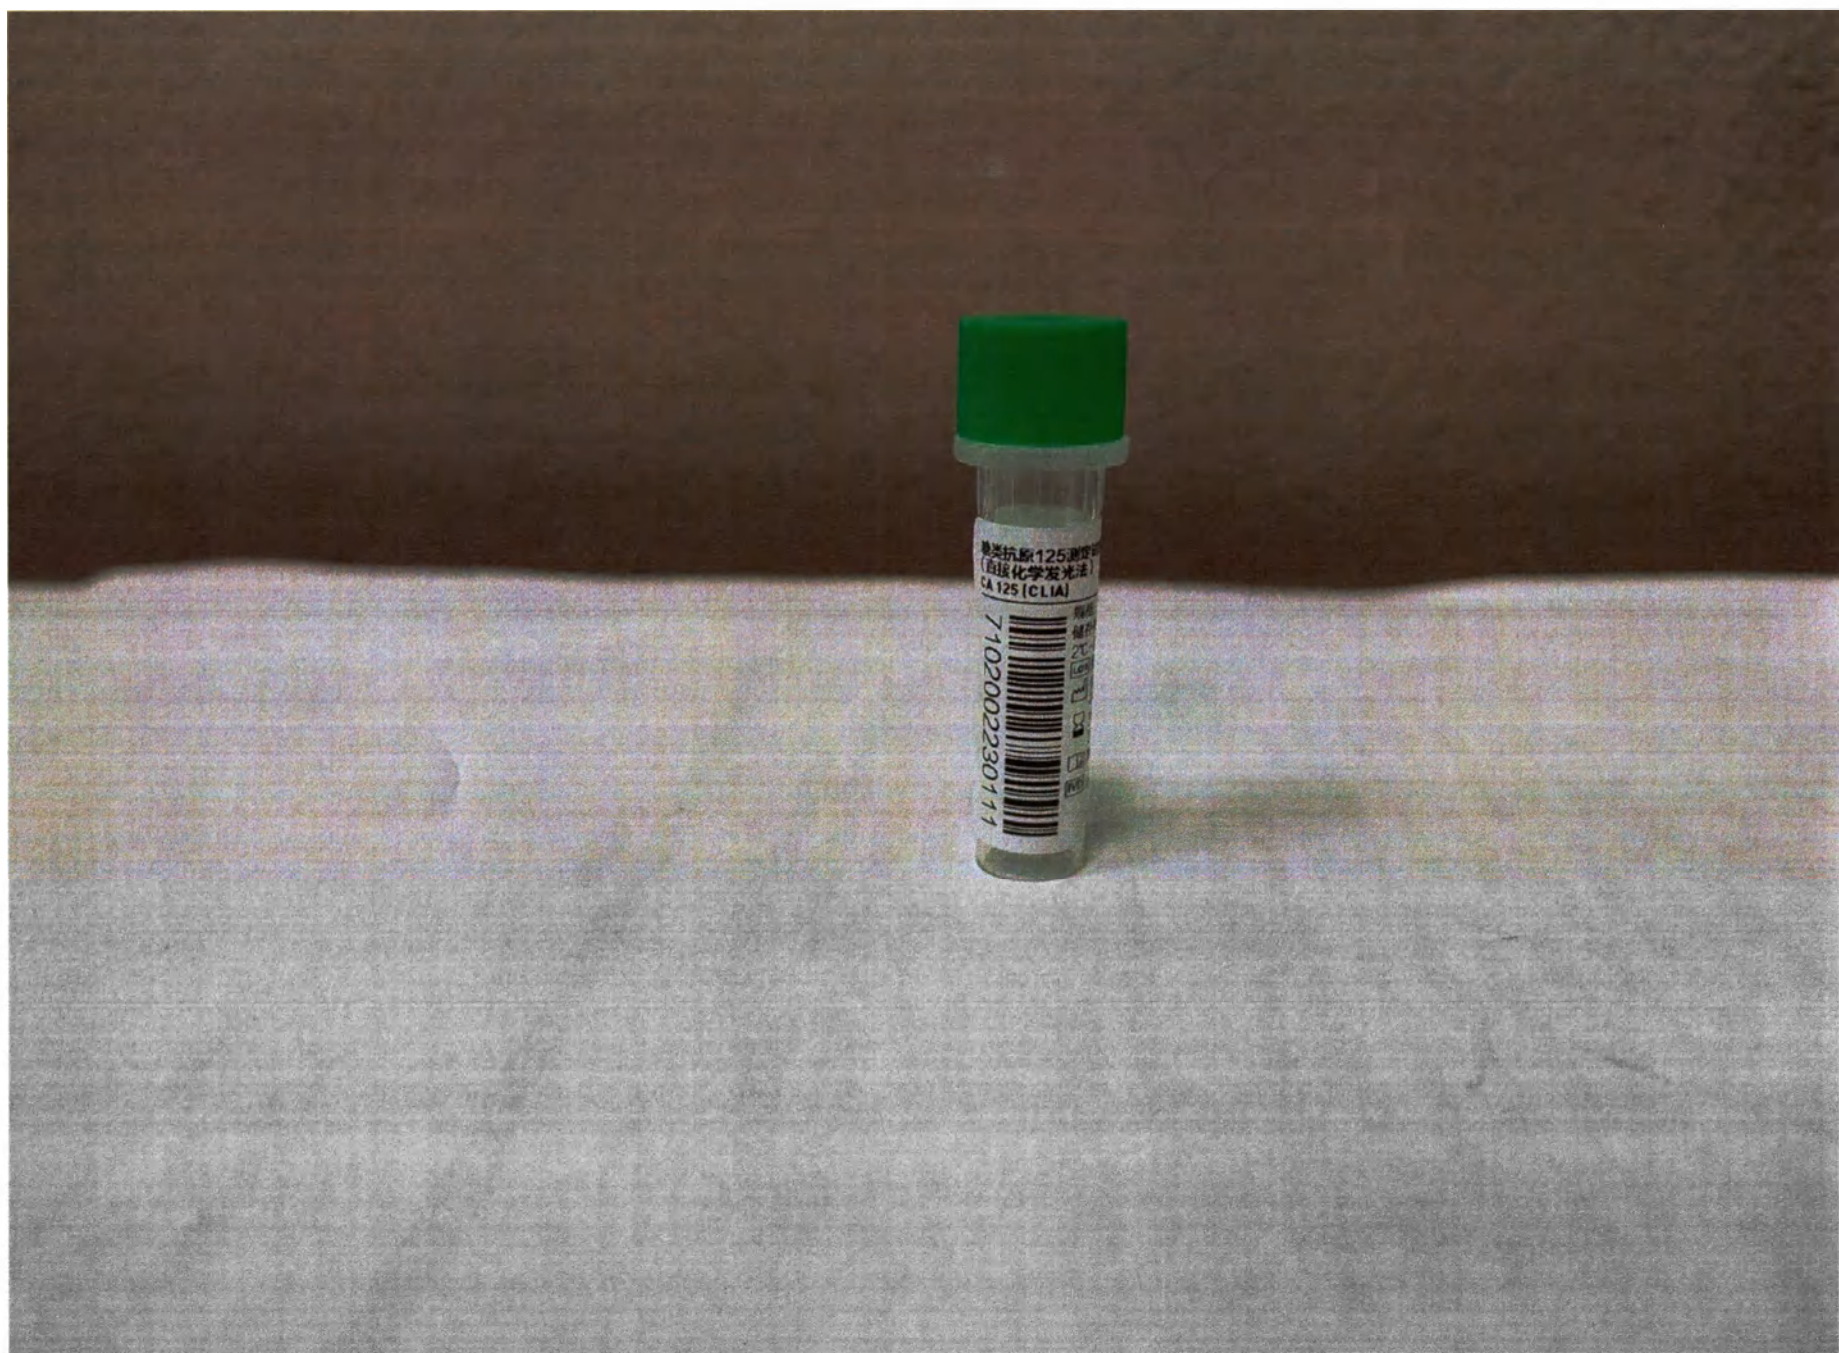


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массига i (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

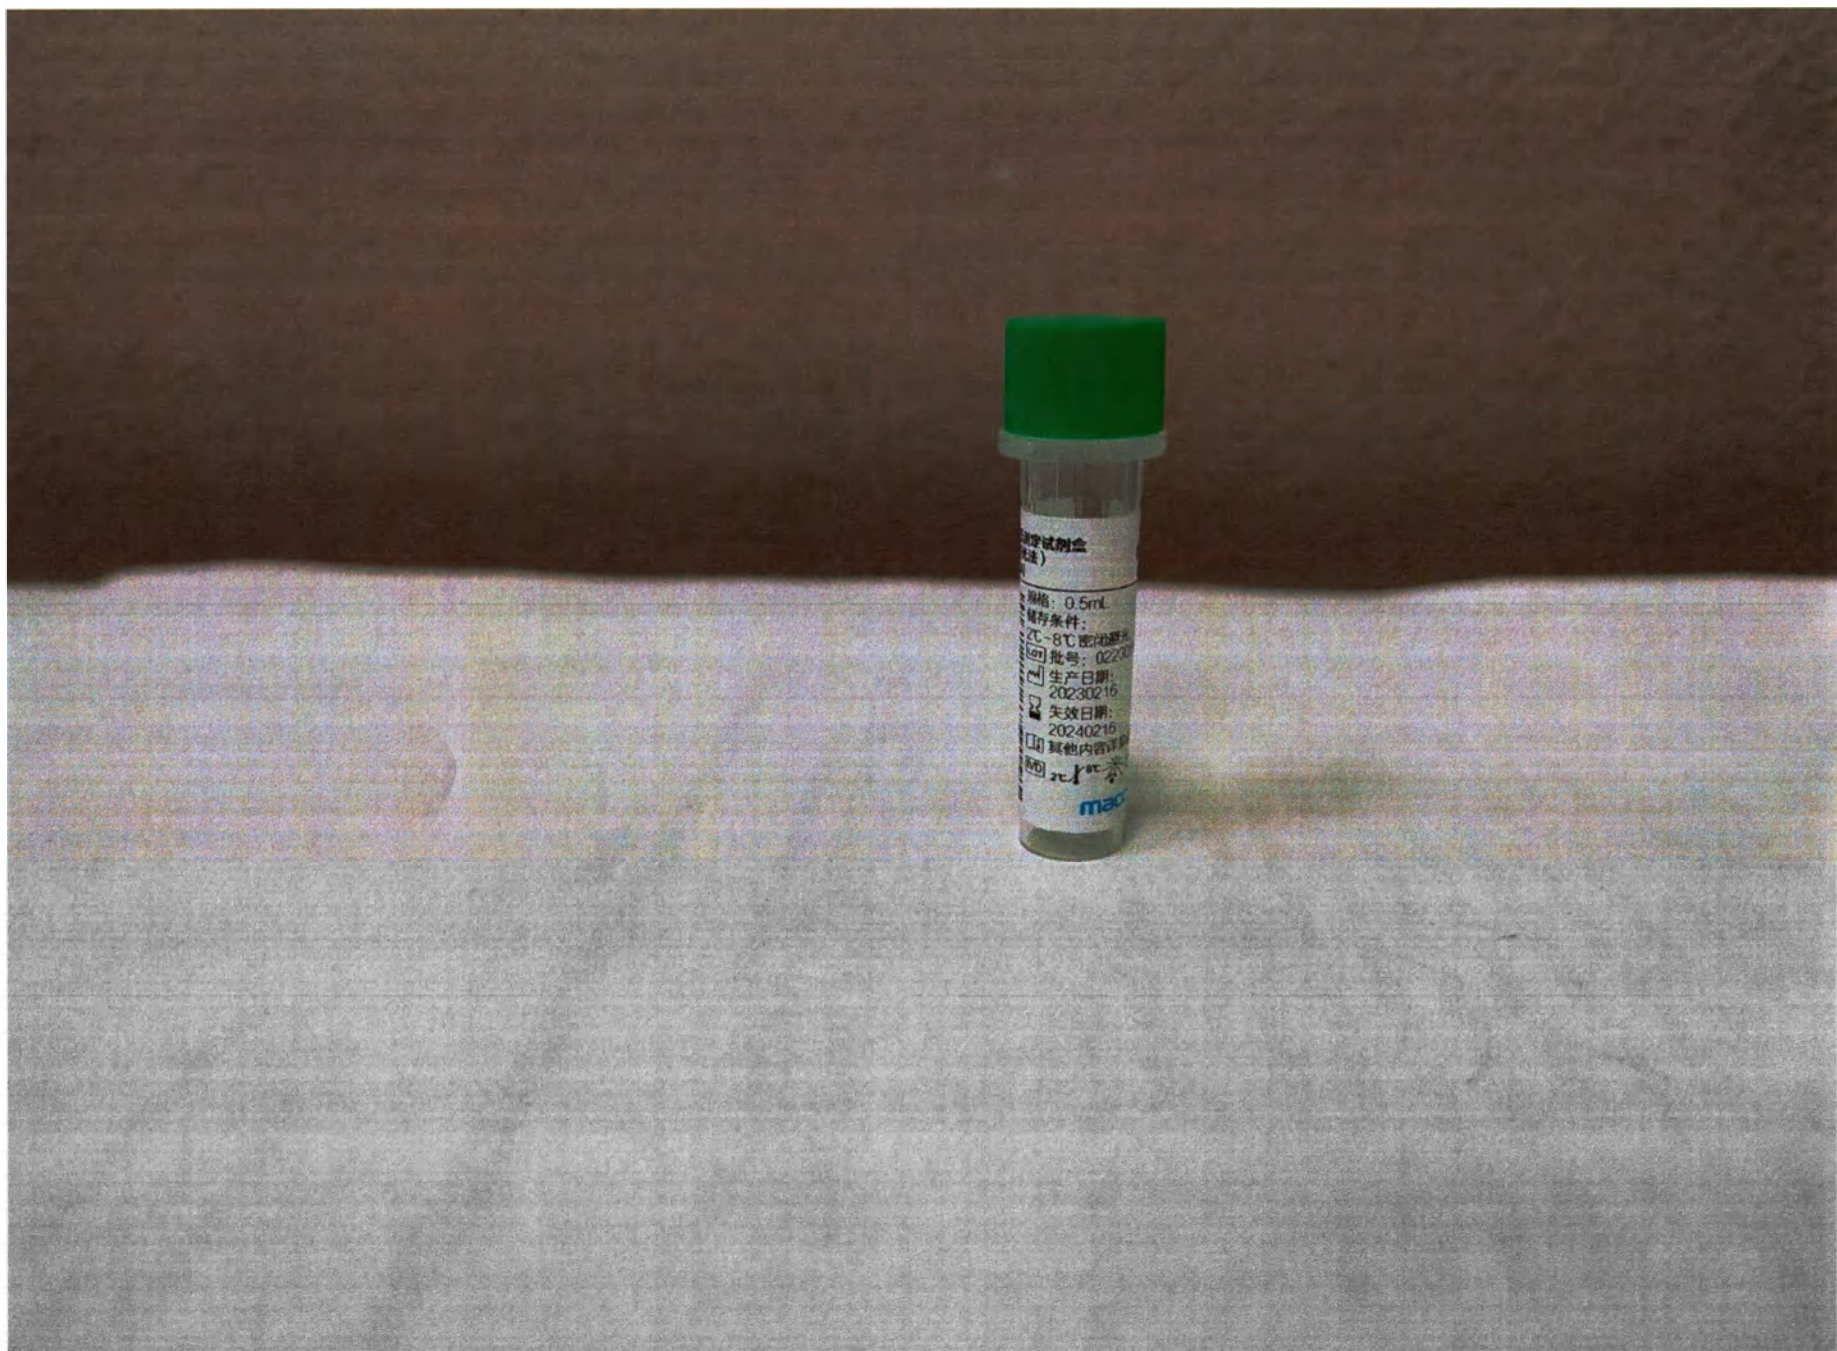

Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения углеводного антигена СА 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массига i (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2




Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

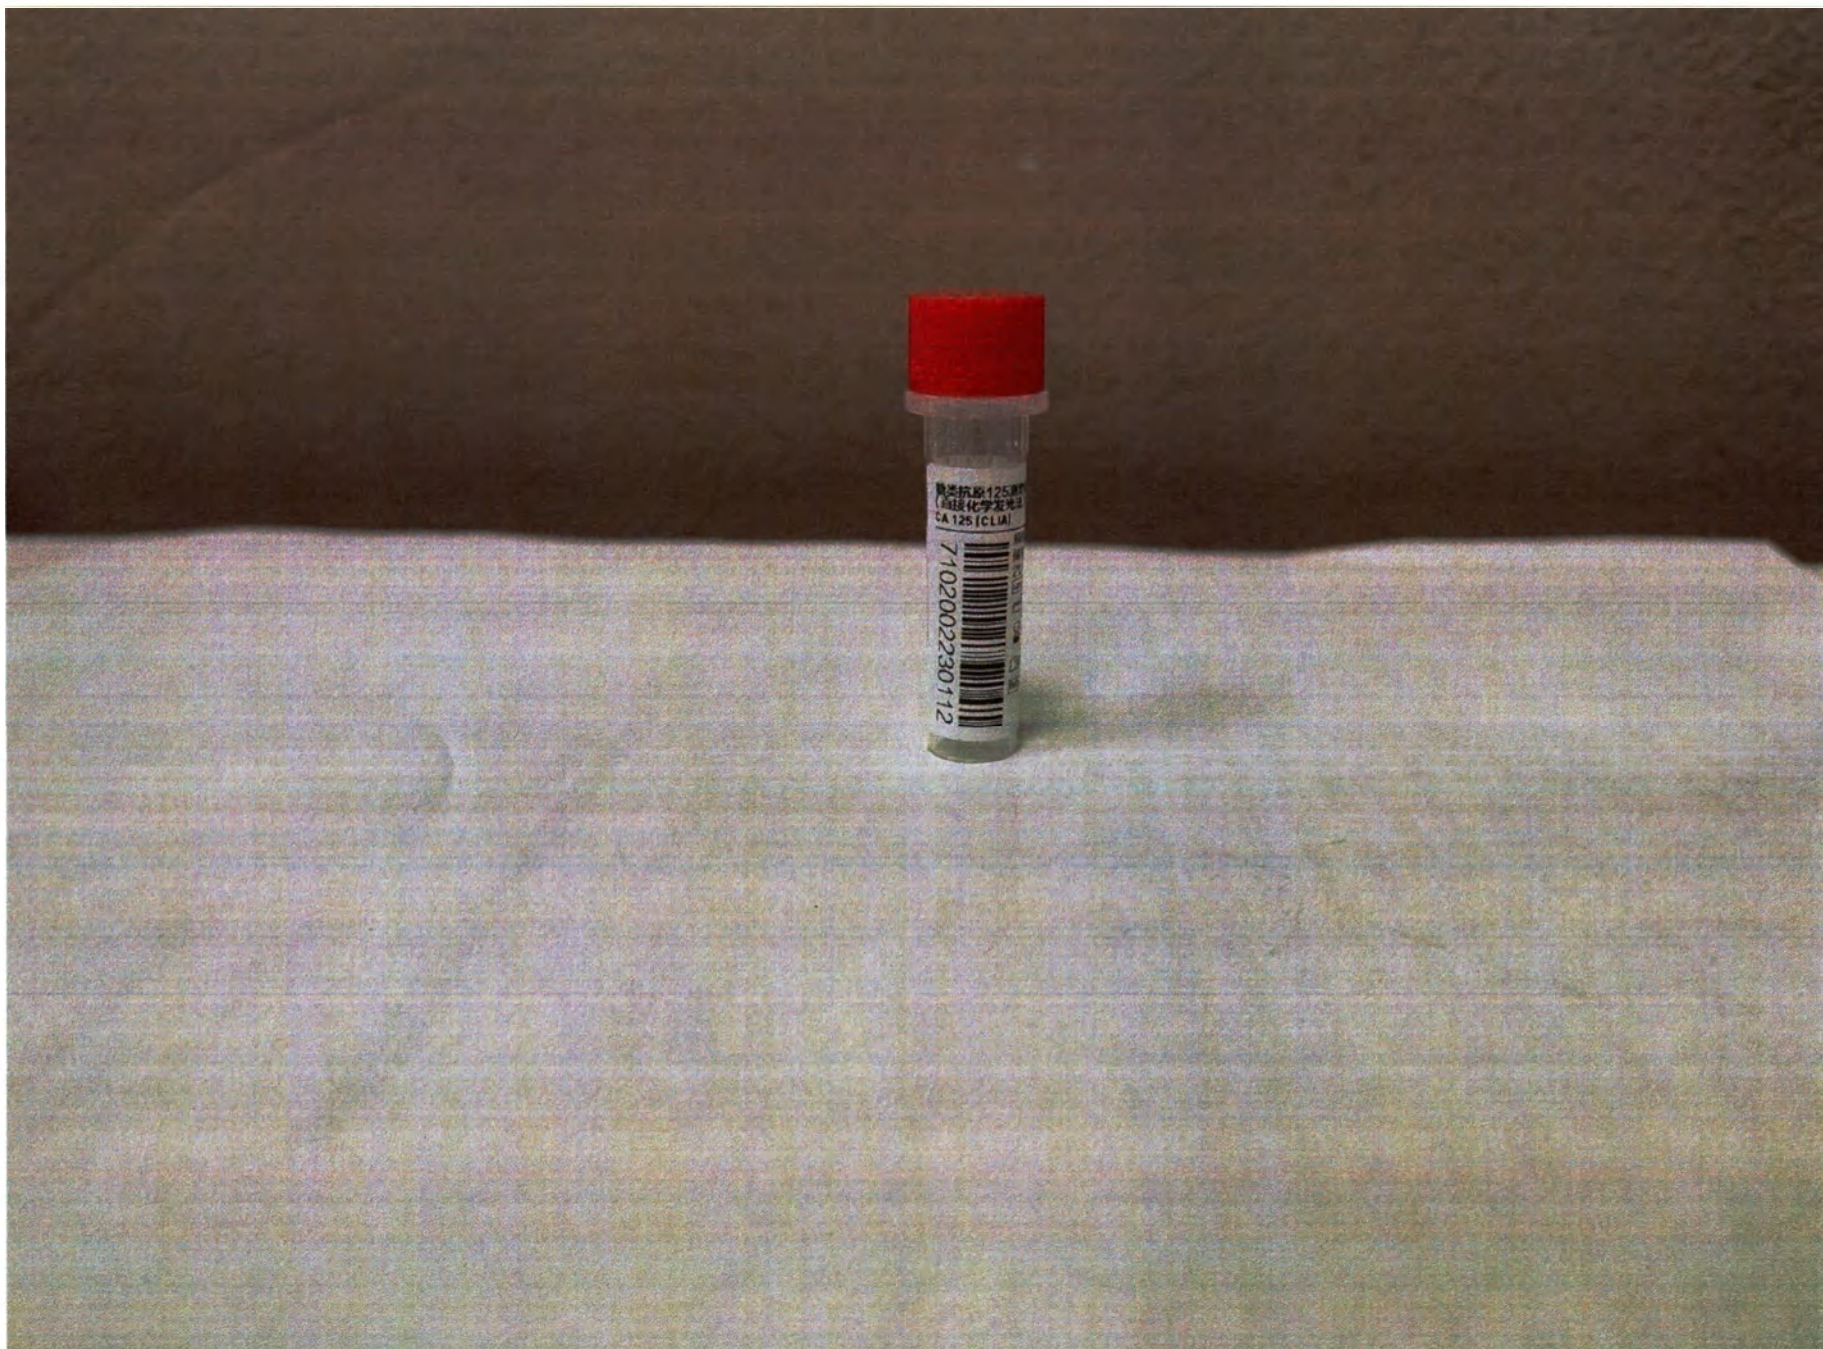


Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массига i (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1



Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массига i (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

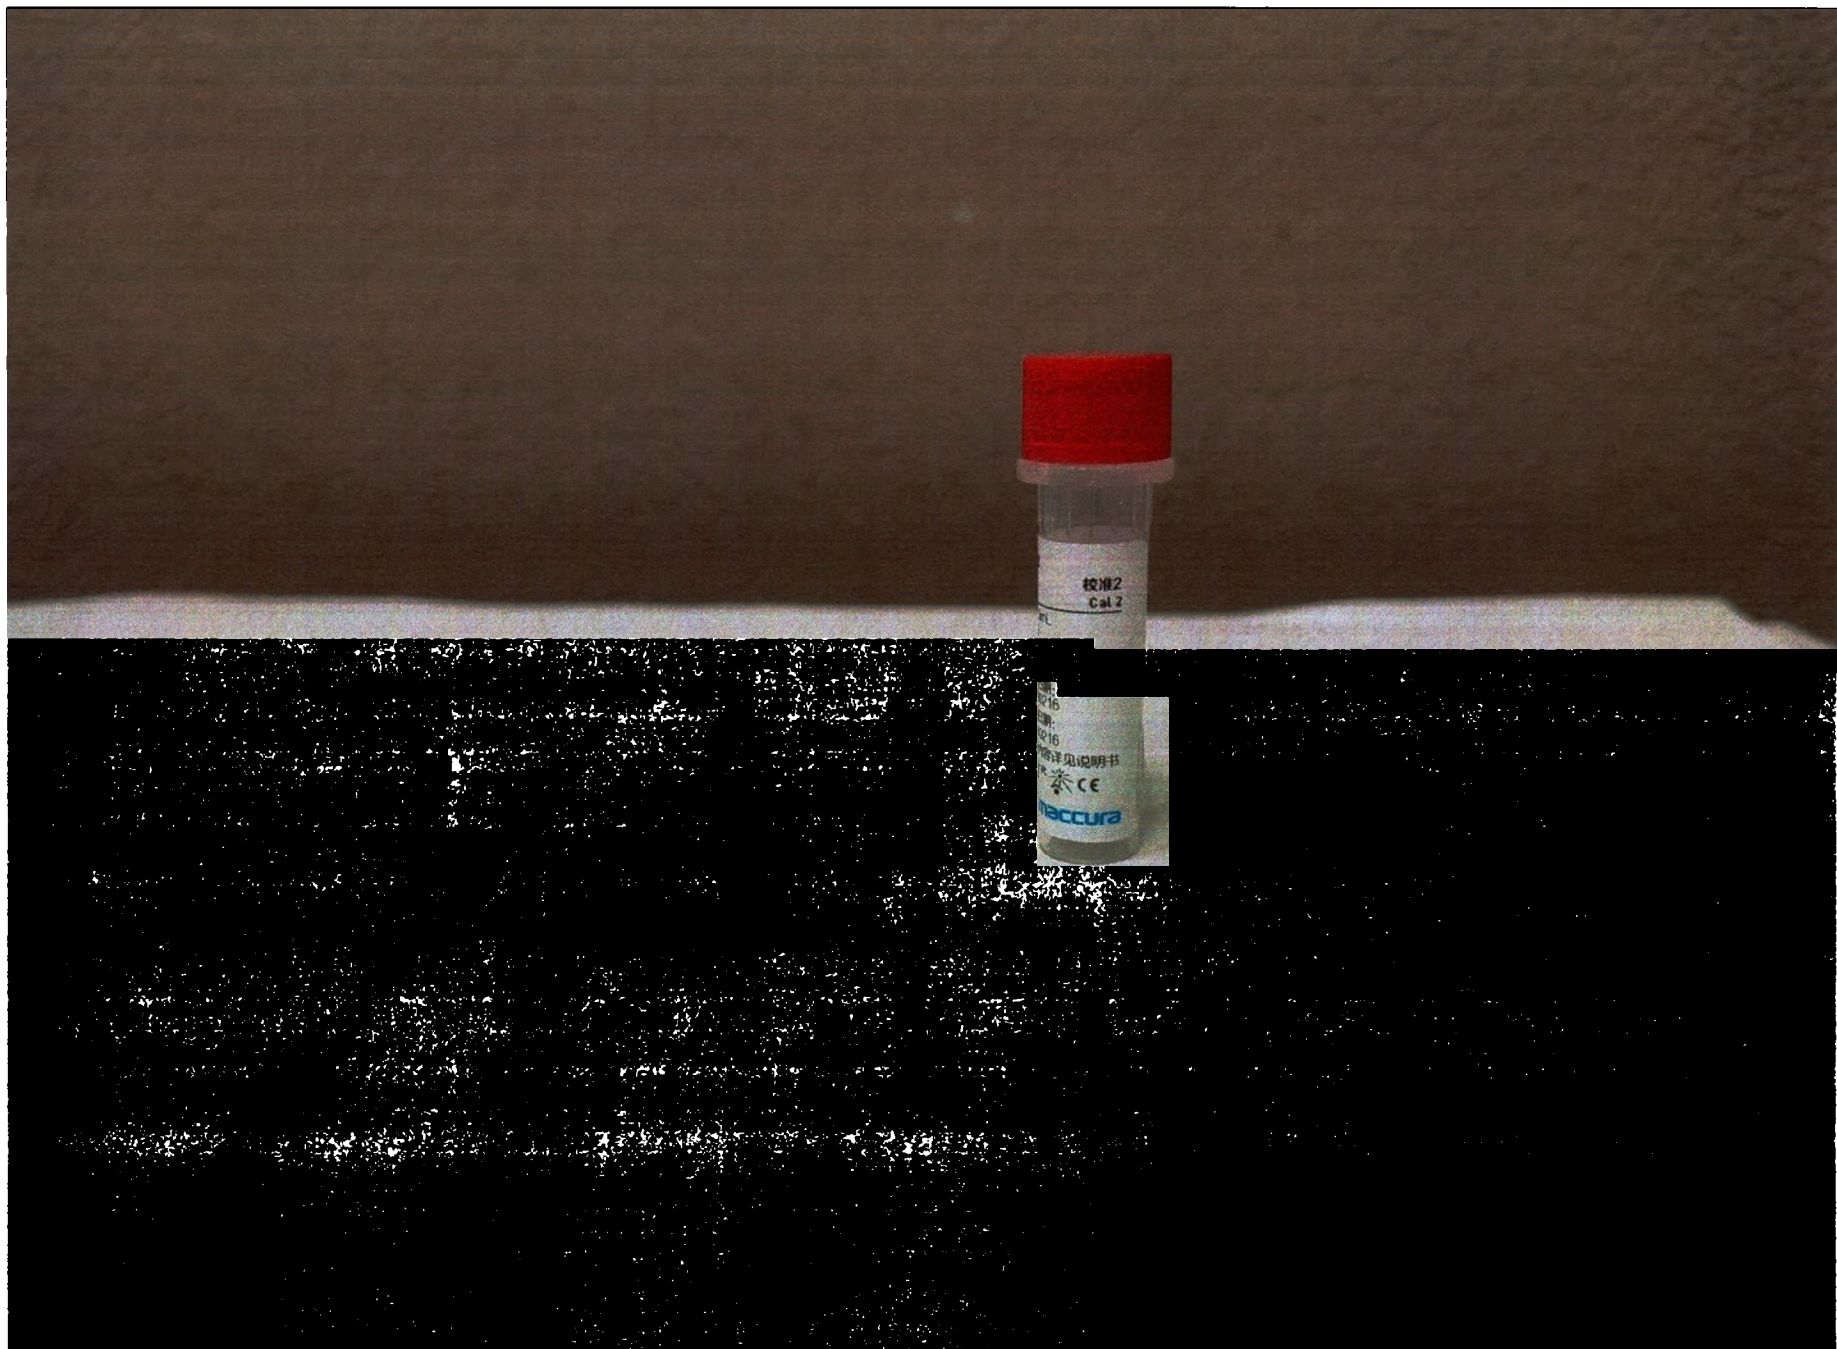

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массира i (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

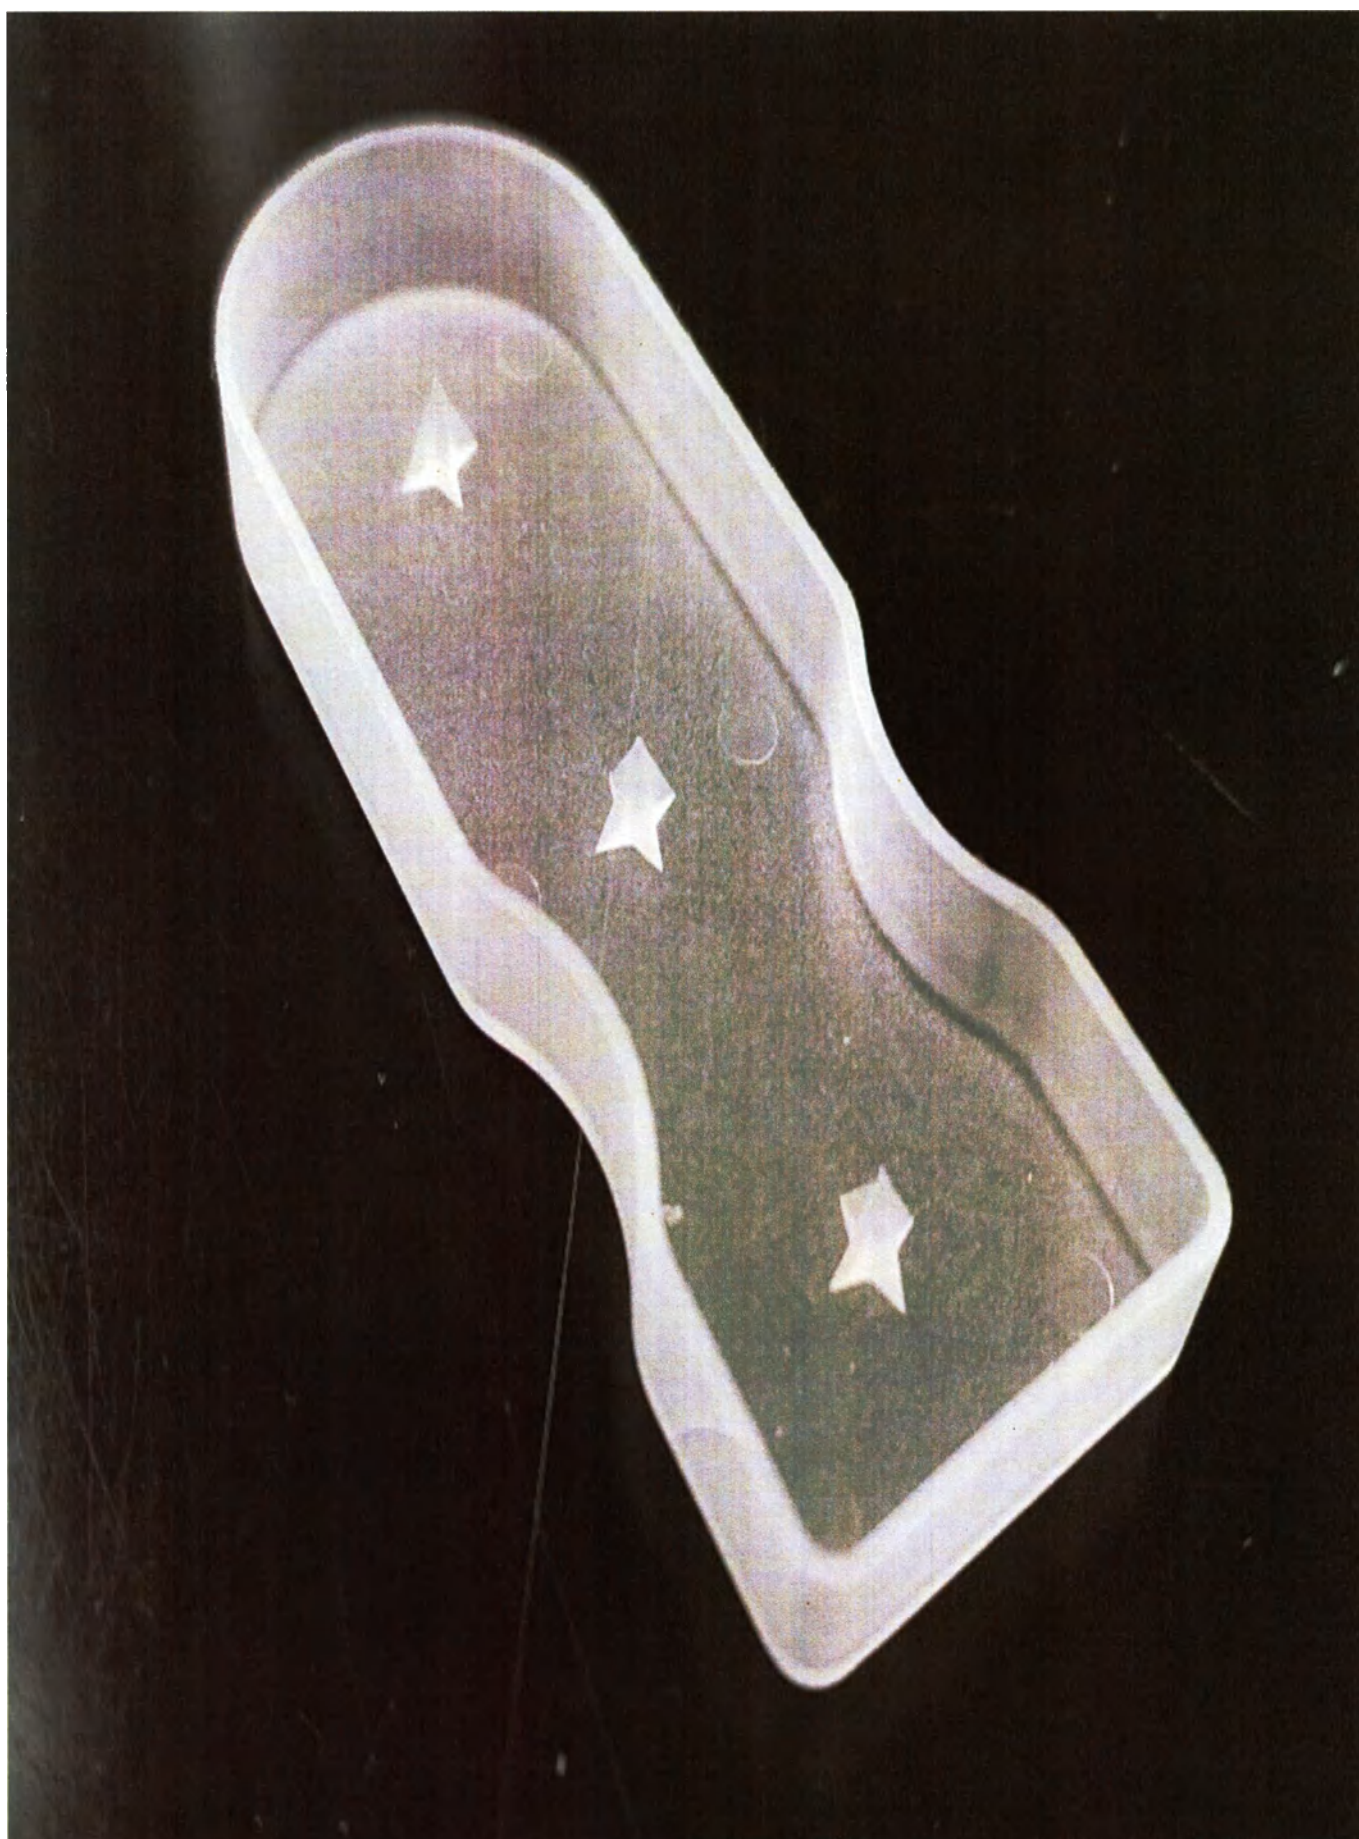

Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура і (CA 125 (CLIA)), набор на 200 тестов

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16 листов


Р.К. Мелконян
Директор ООО «Эвопром»

