

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccuga i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов


**производства Maccuga Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan
Road,Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China**



Общий вид МИ «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Massura i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид спереди «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов»

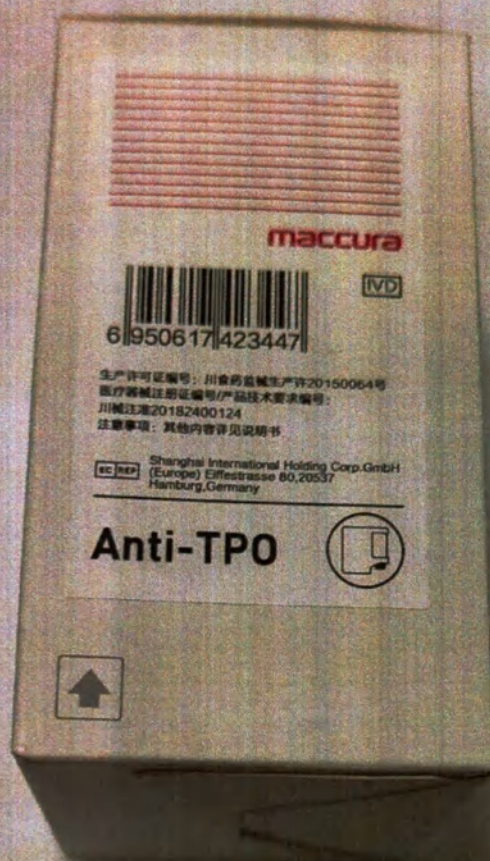

Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司
住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号
电话: + 86 28 8782 6777
传真: + 86 28 8782 5783
邮编: 611731
邮箱: maccura@maccura.com




Maccura Biotechnology Co., Ltd.
Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731
Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel : +86 28 8782 6777
Fax: +86 28 8782 5783
E-mail: maccura@maccura.com

www.maccura.com



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов»

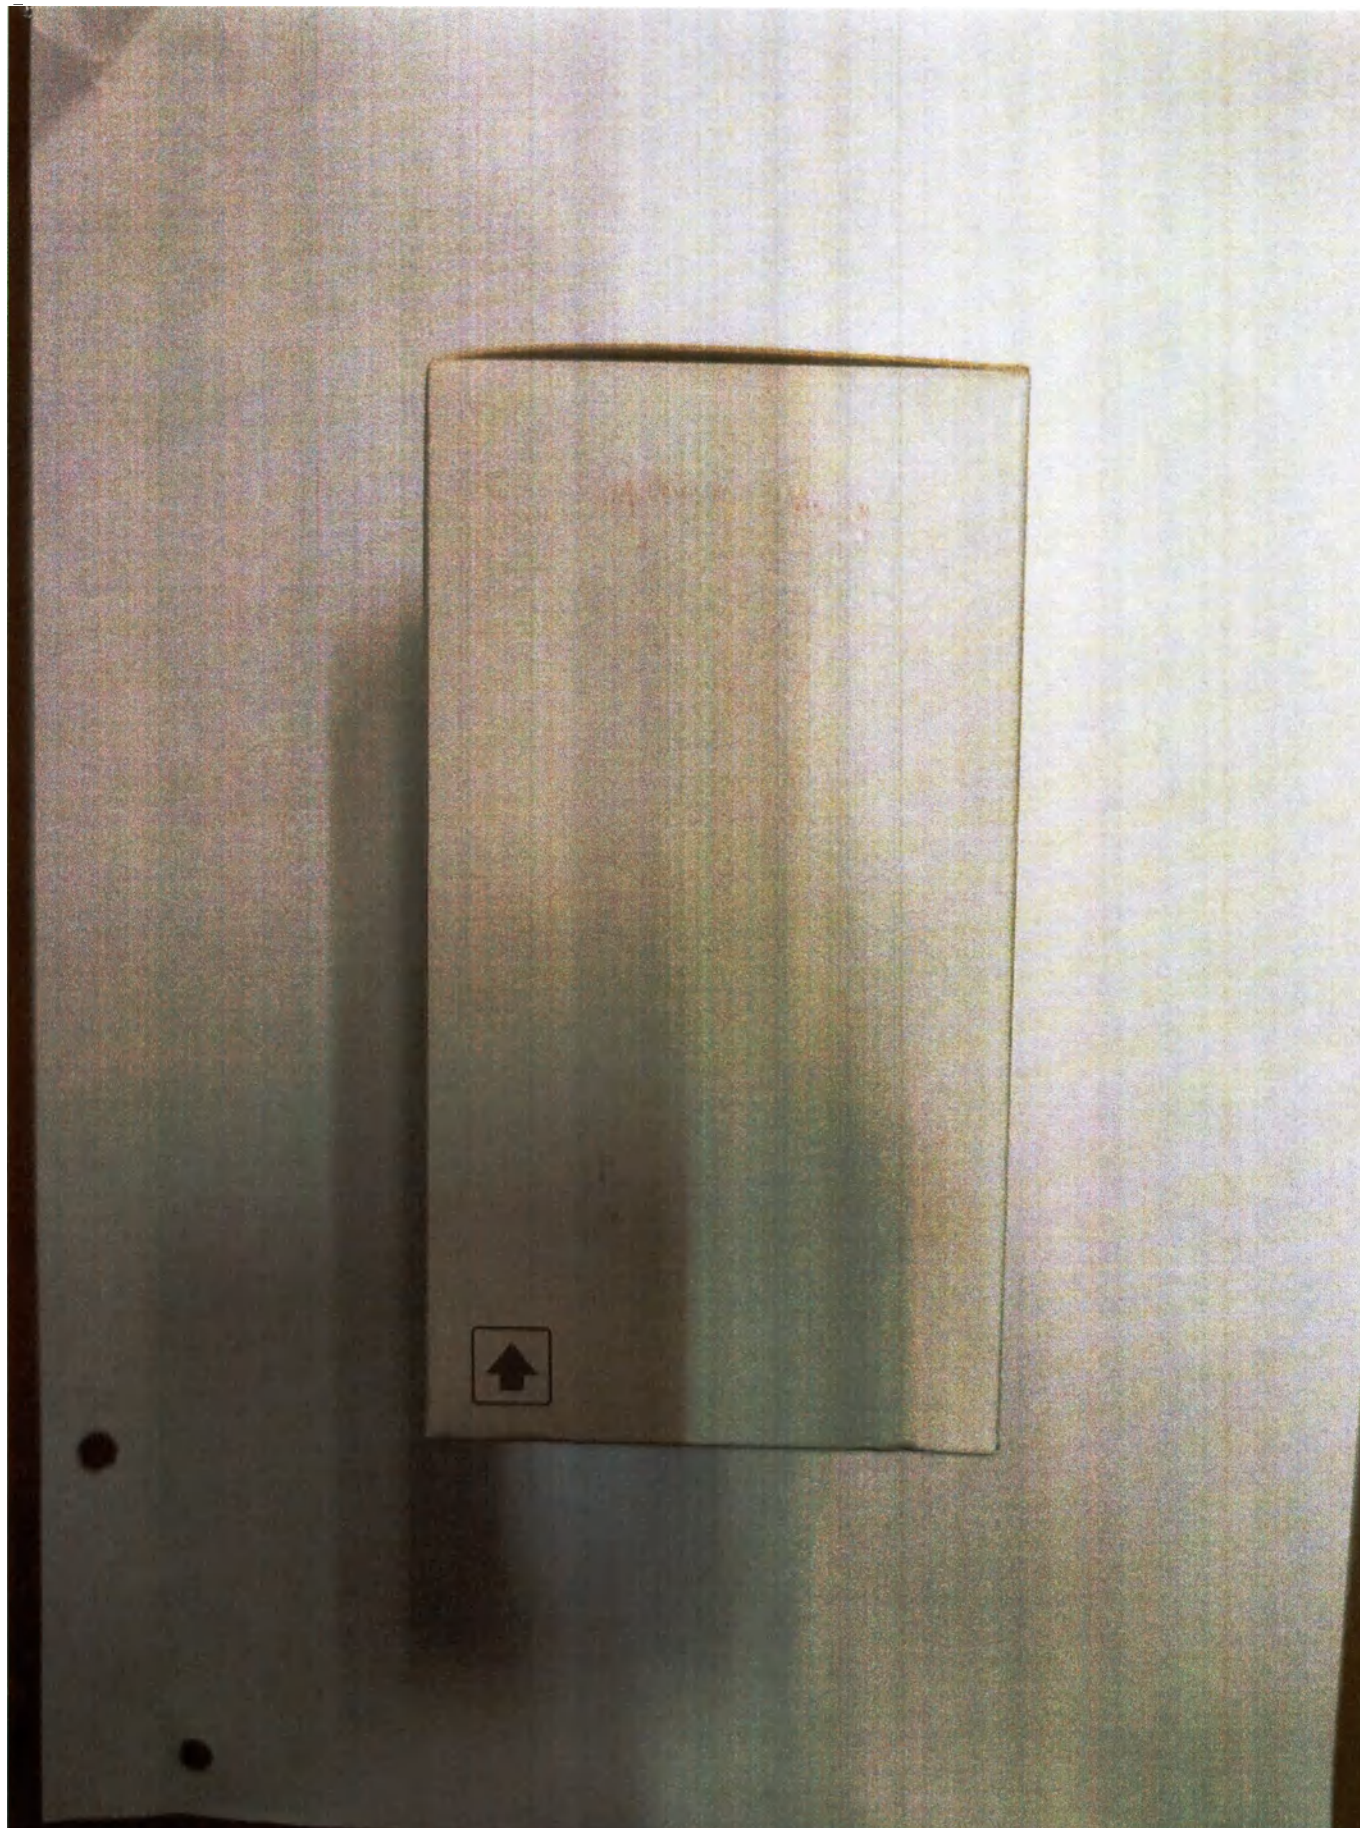


Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов»




Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов»




Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2, R3 «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов»

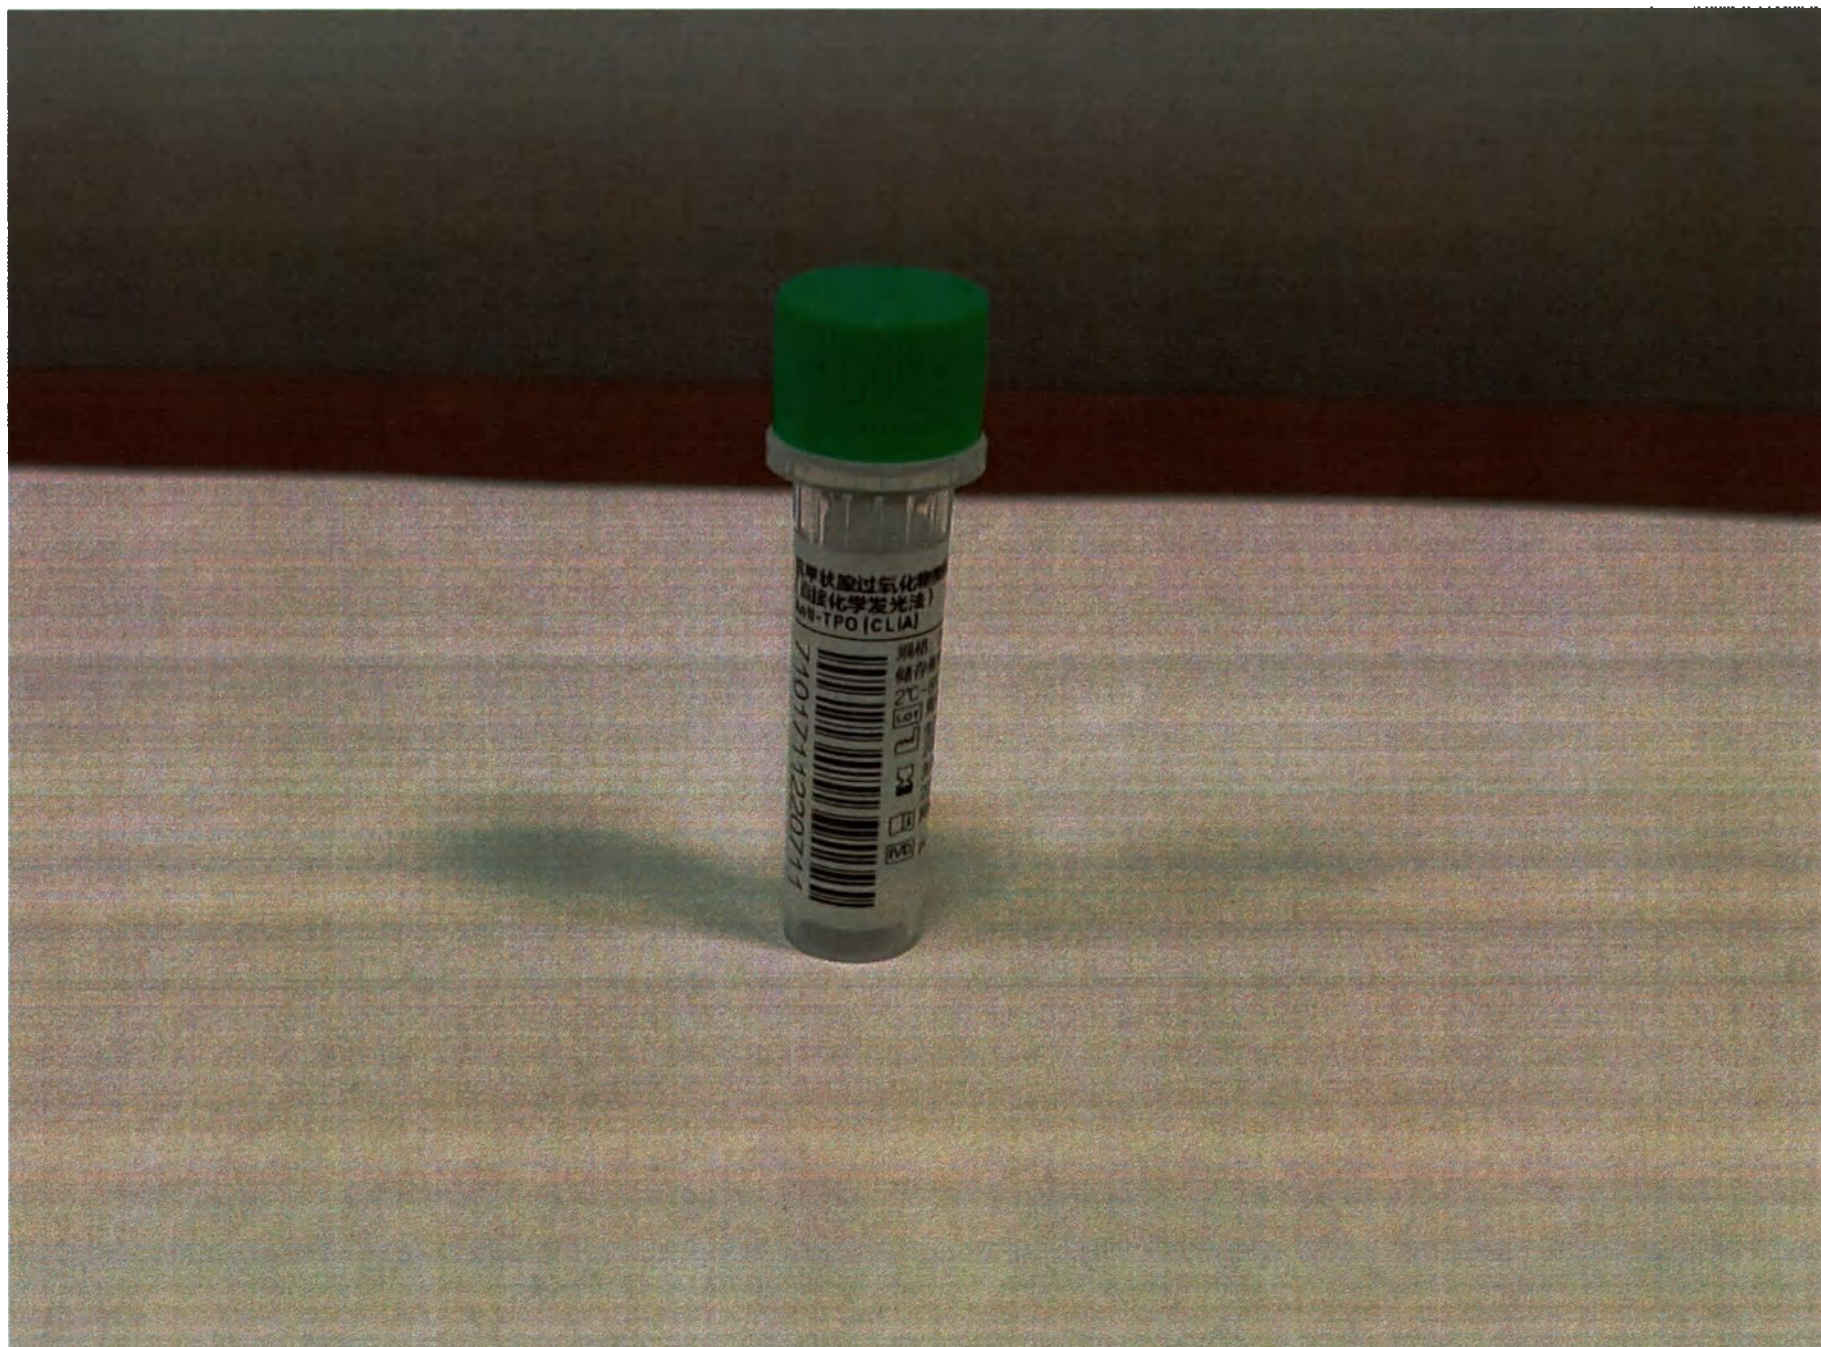


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

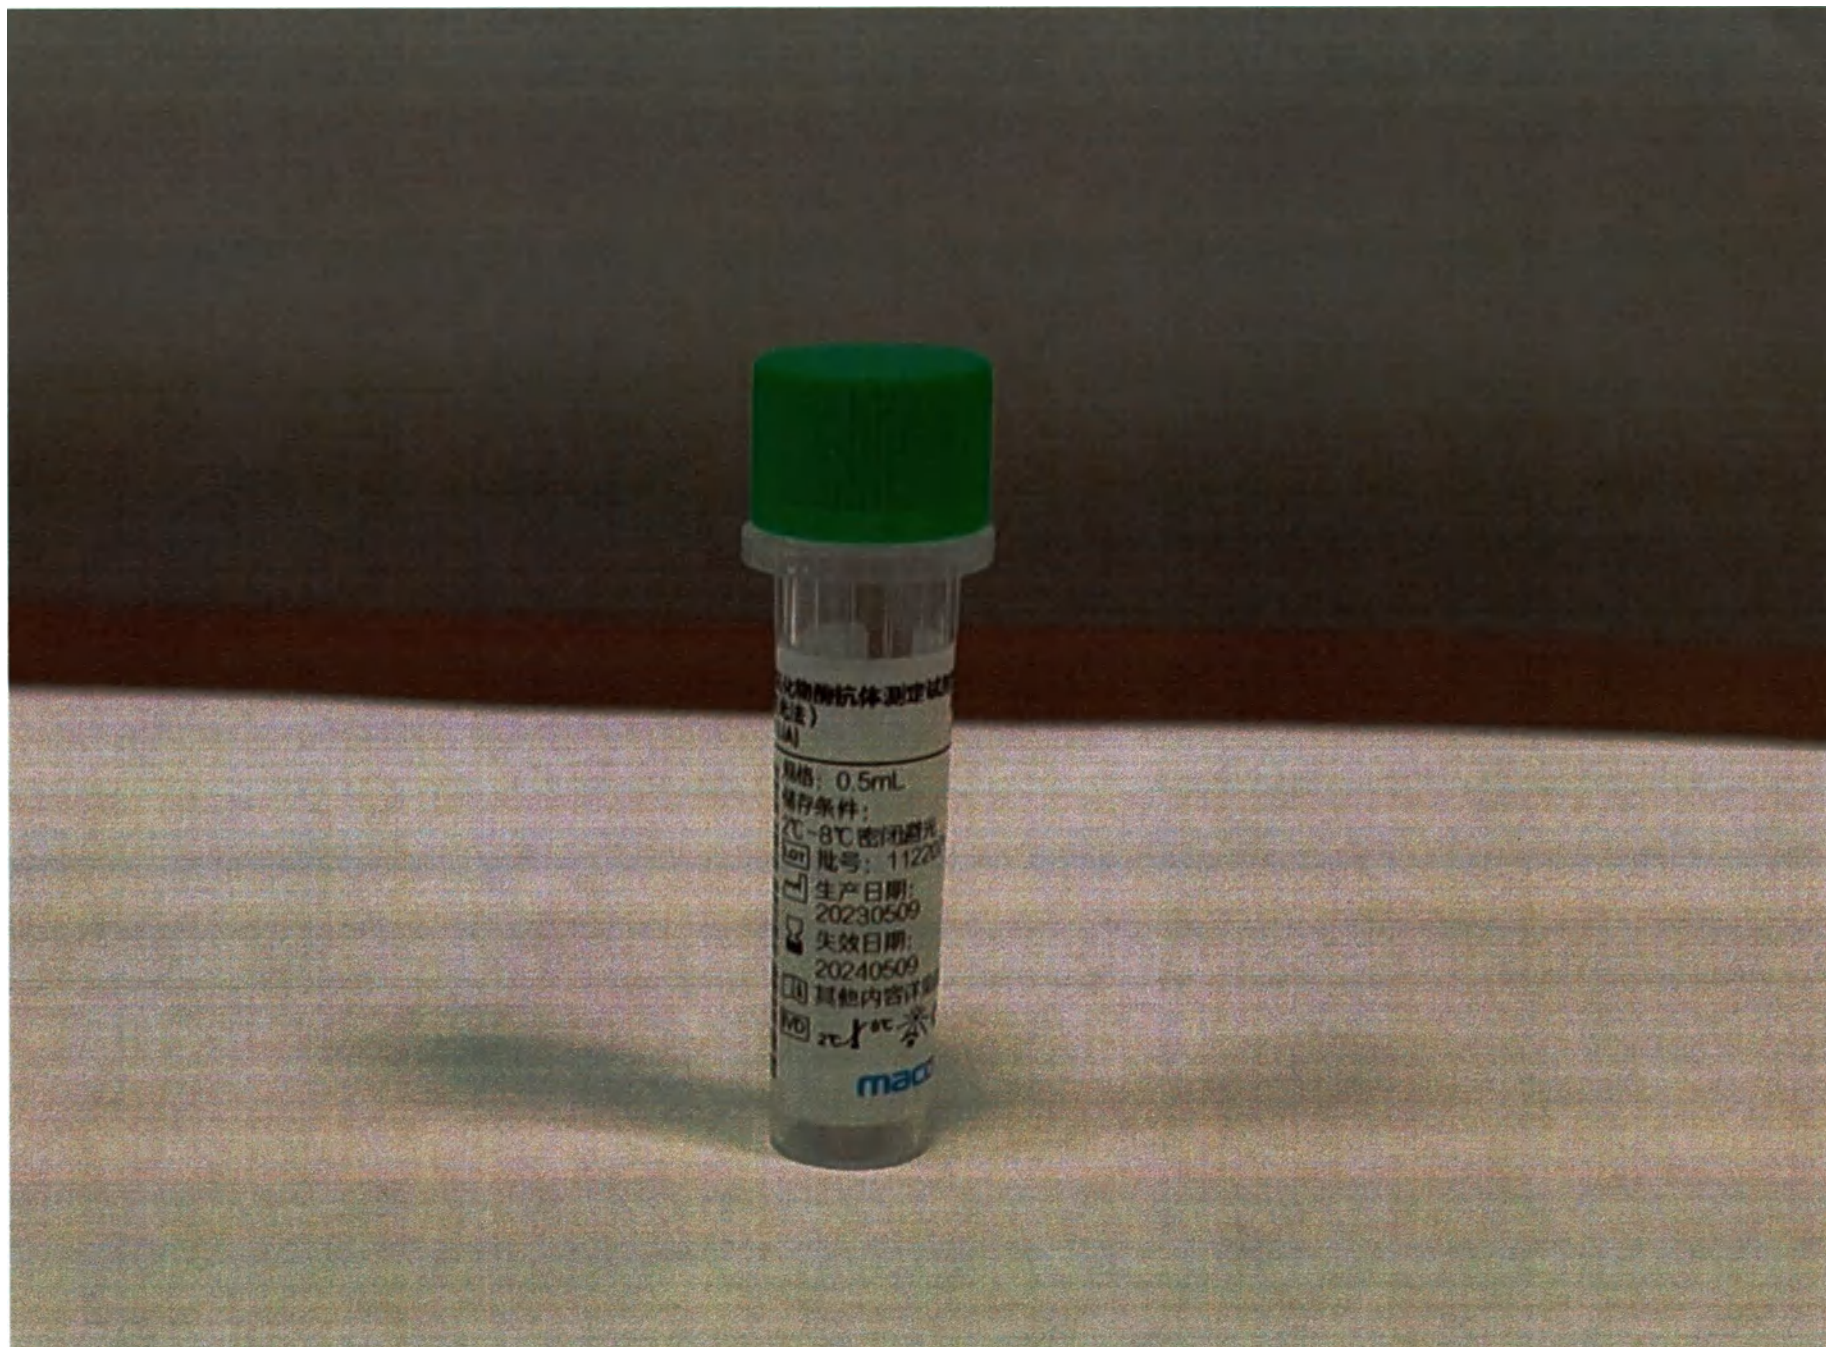


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массига i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

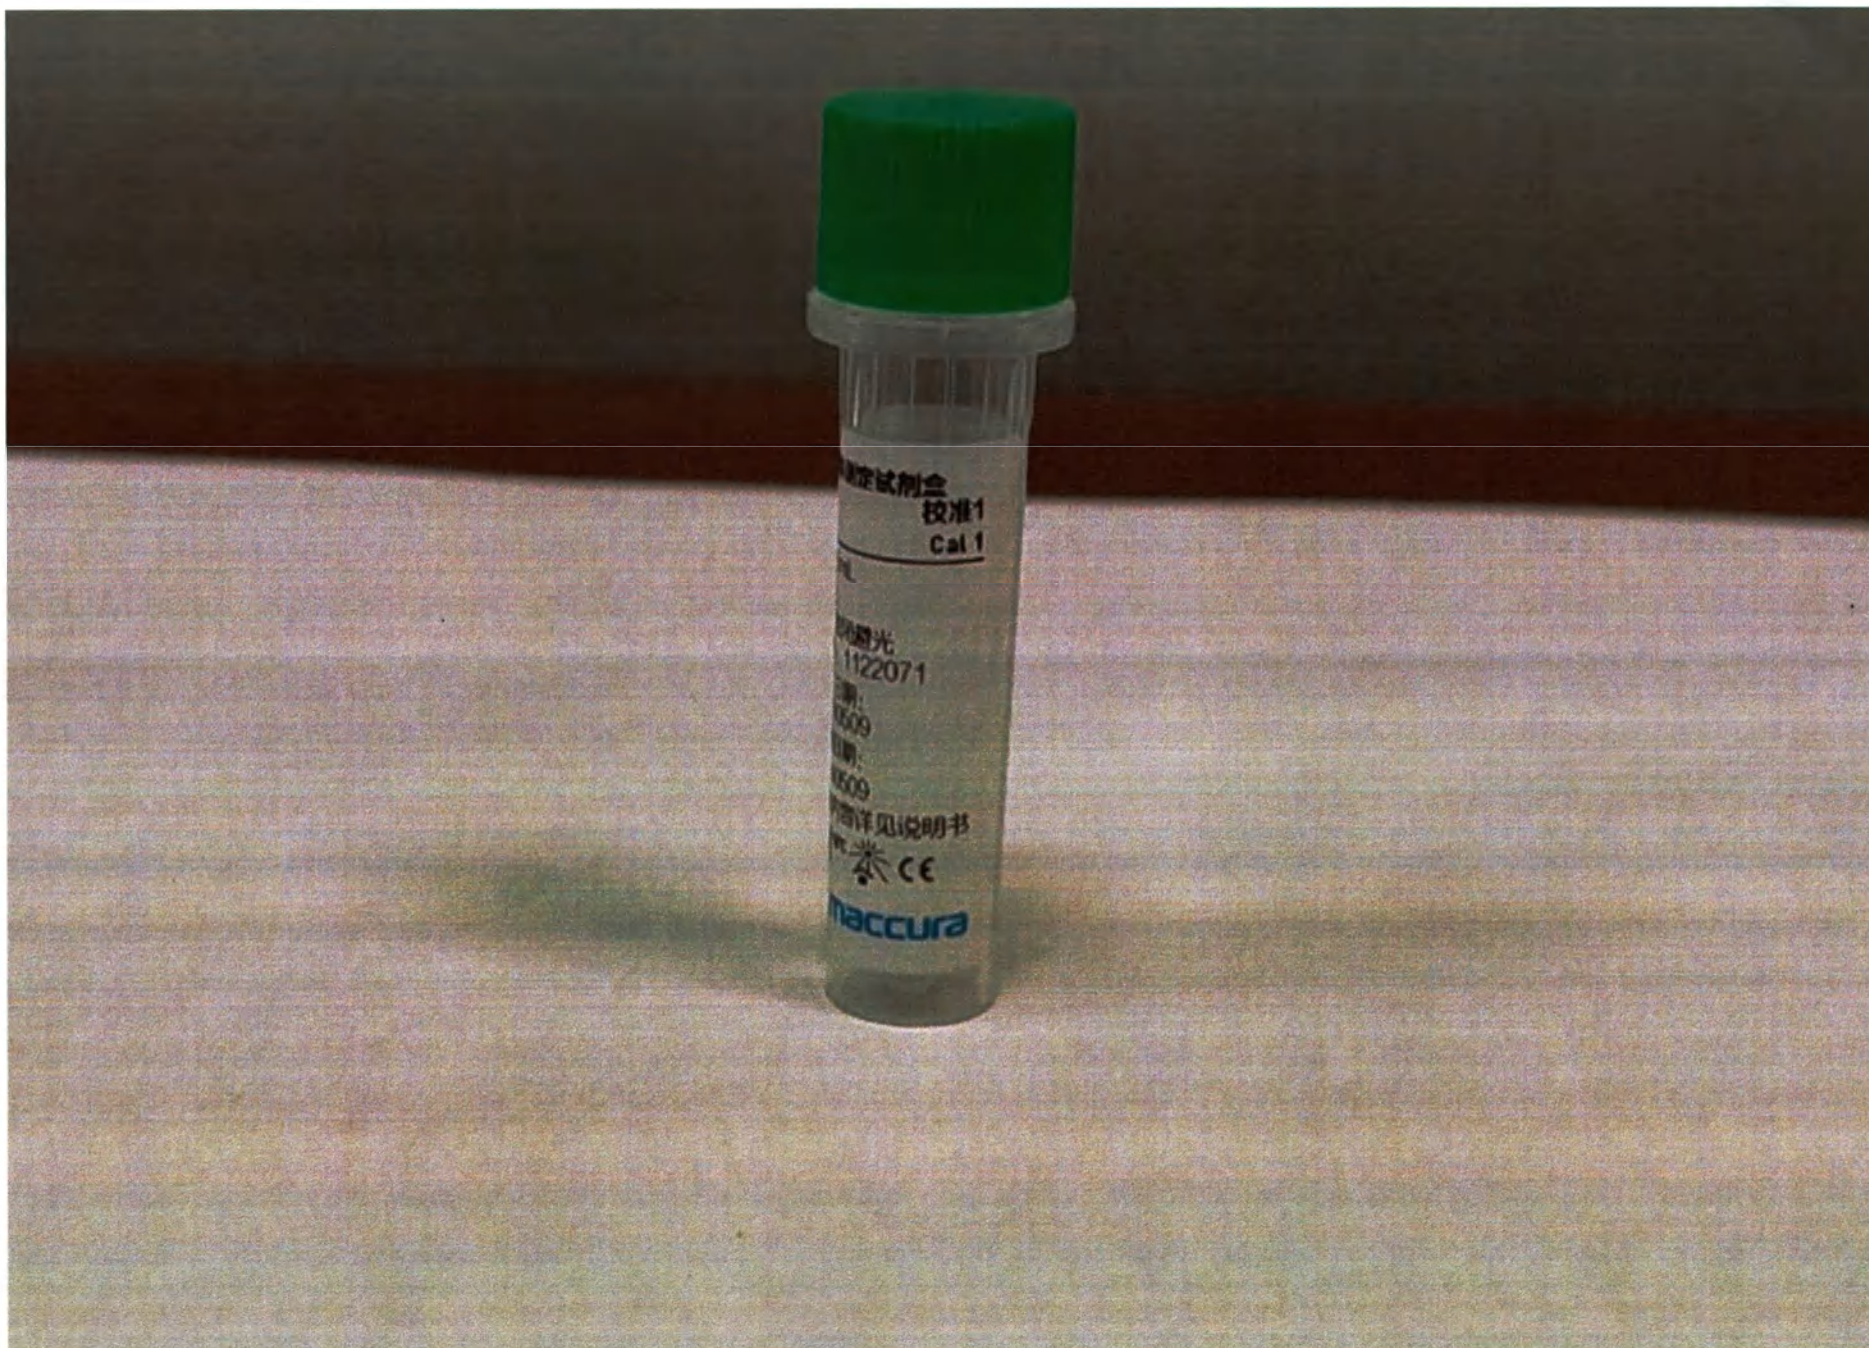


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

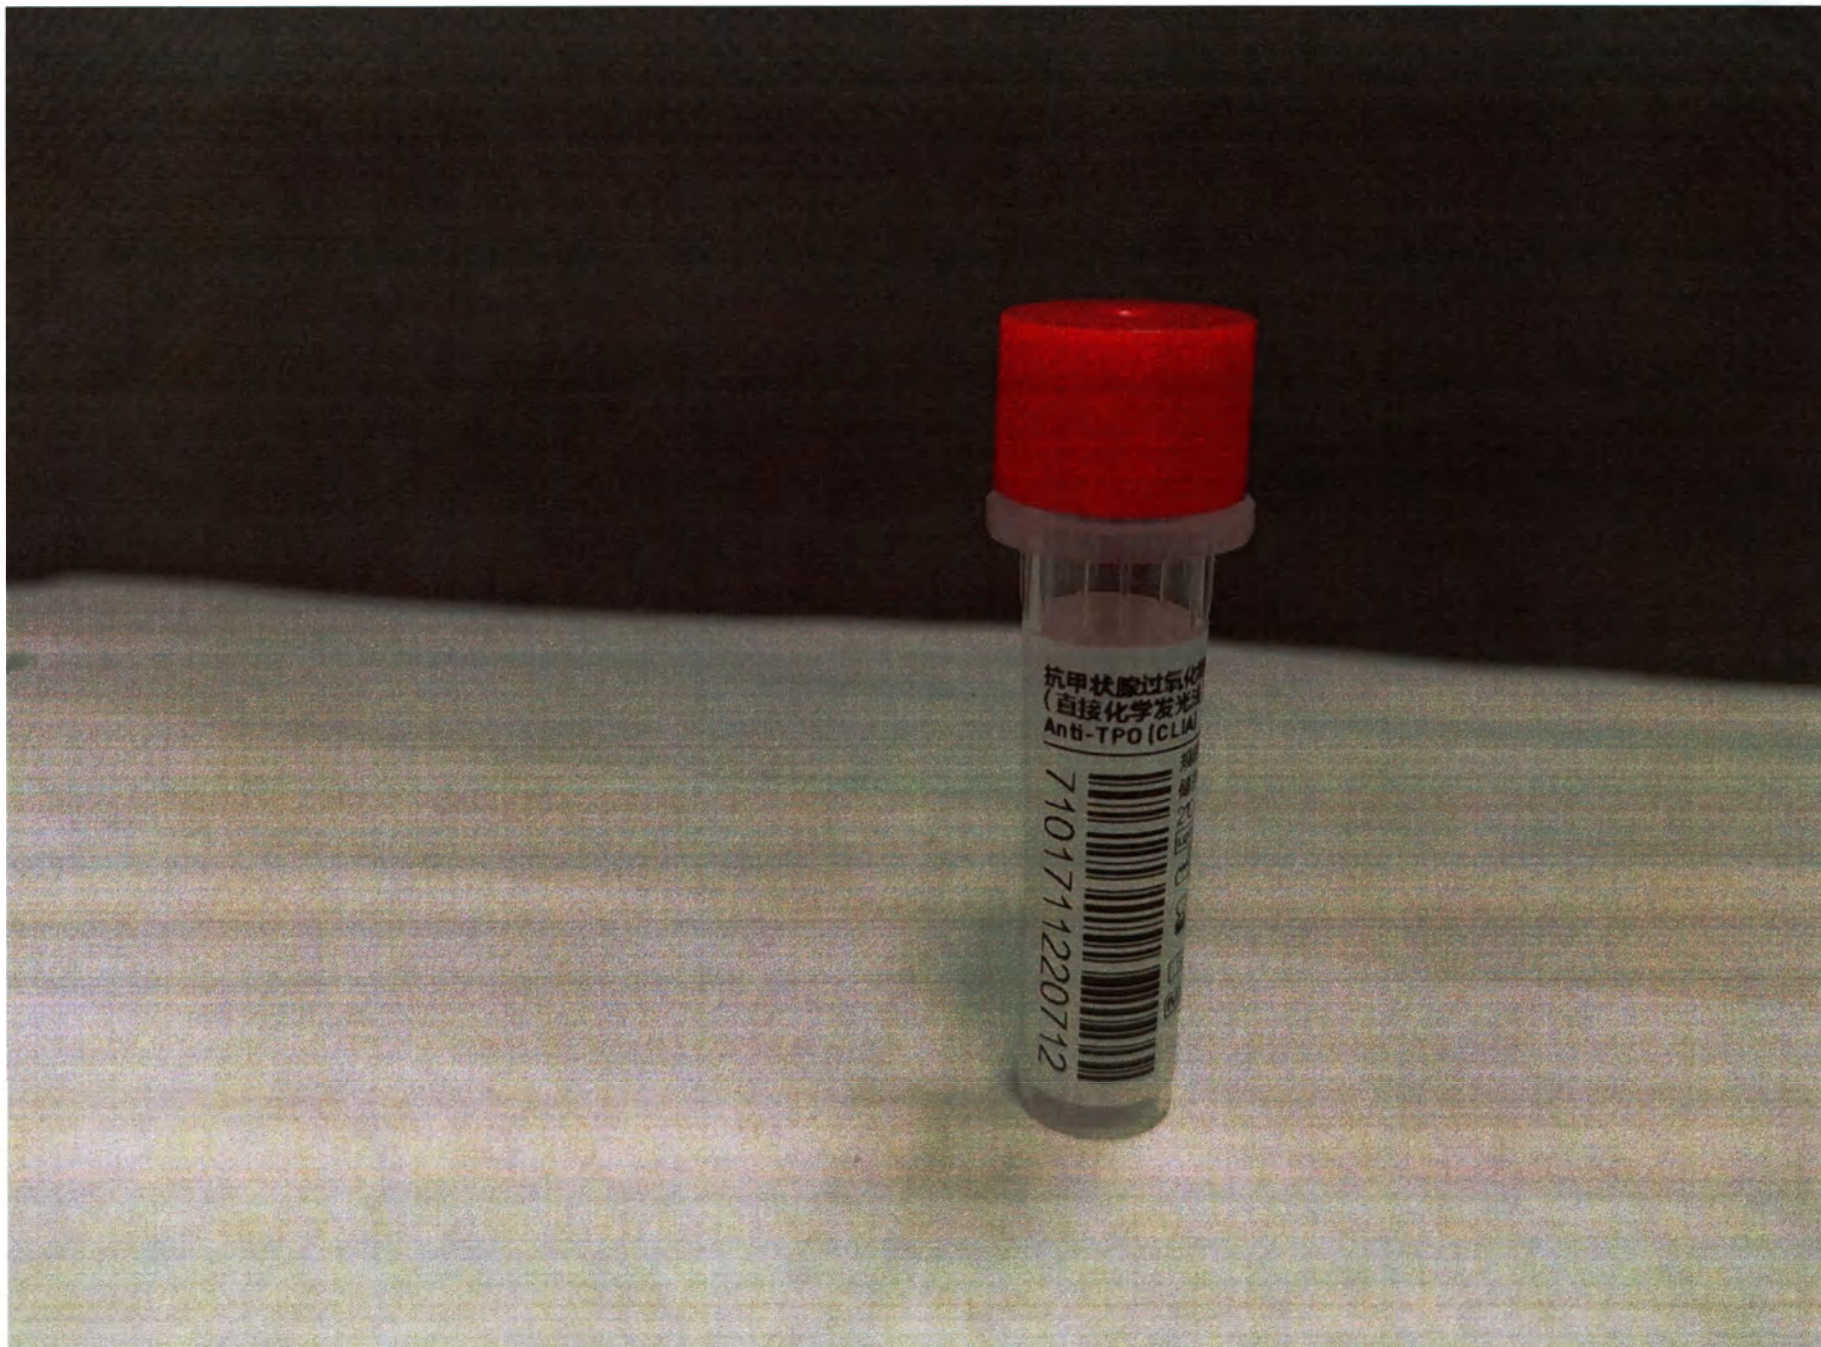


Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

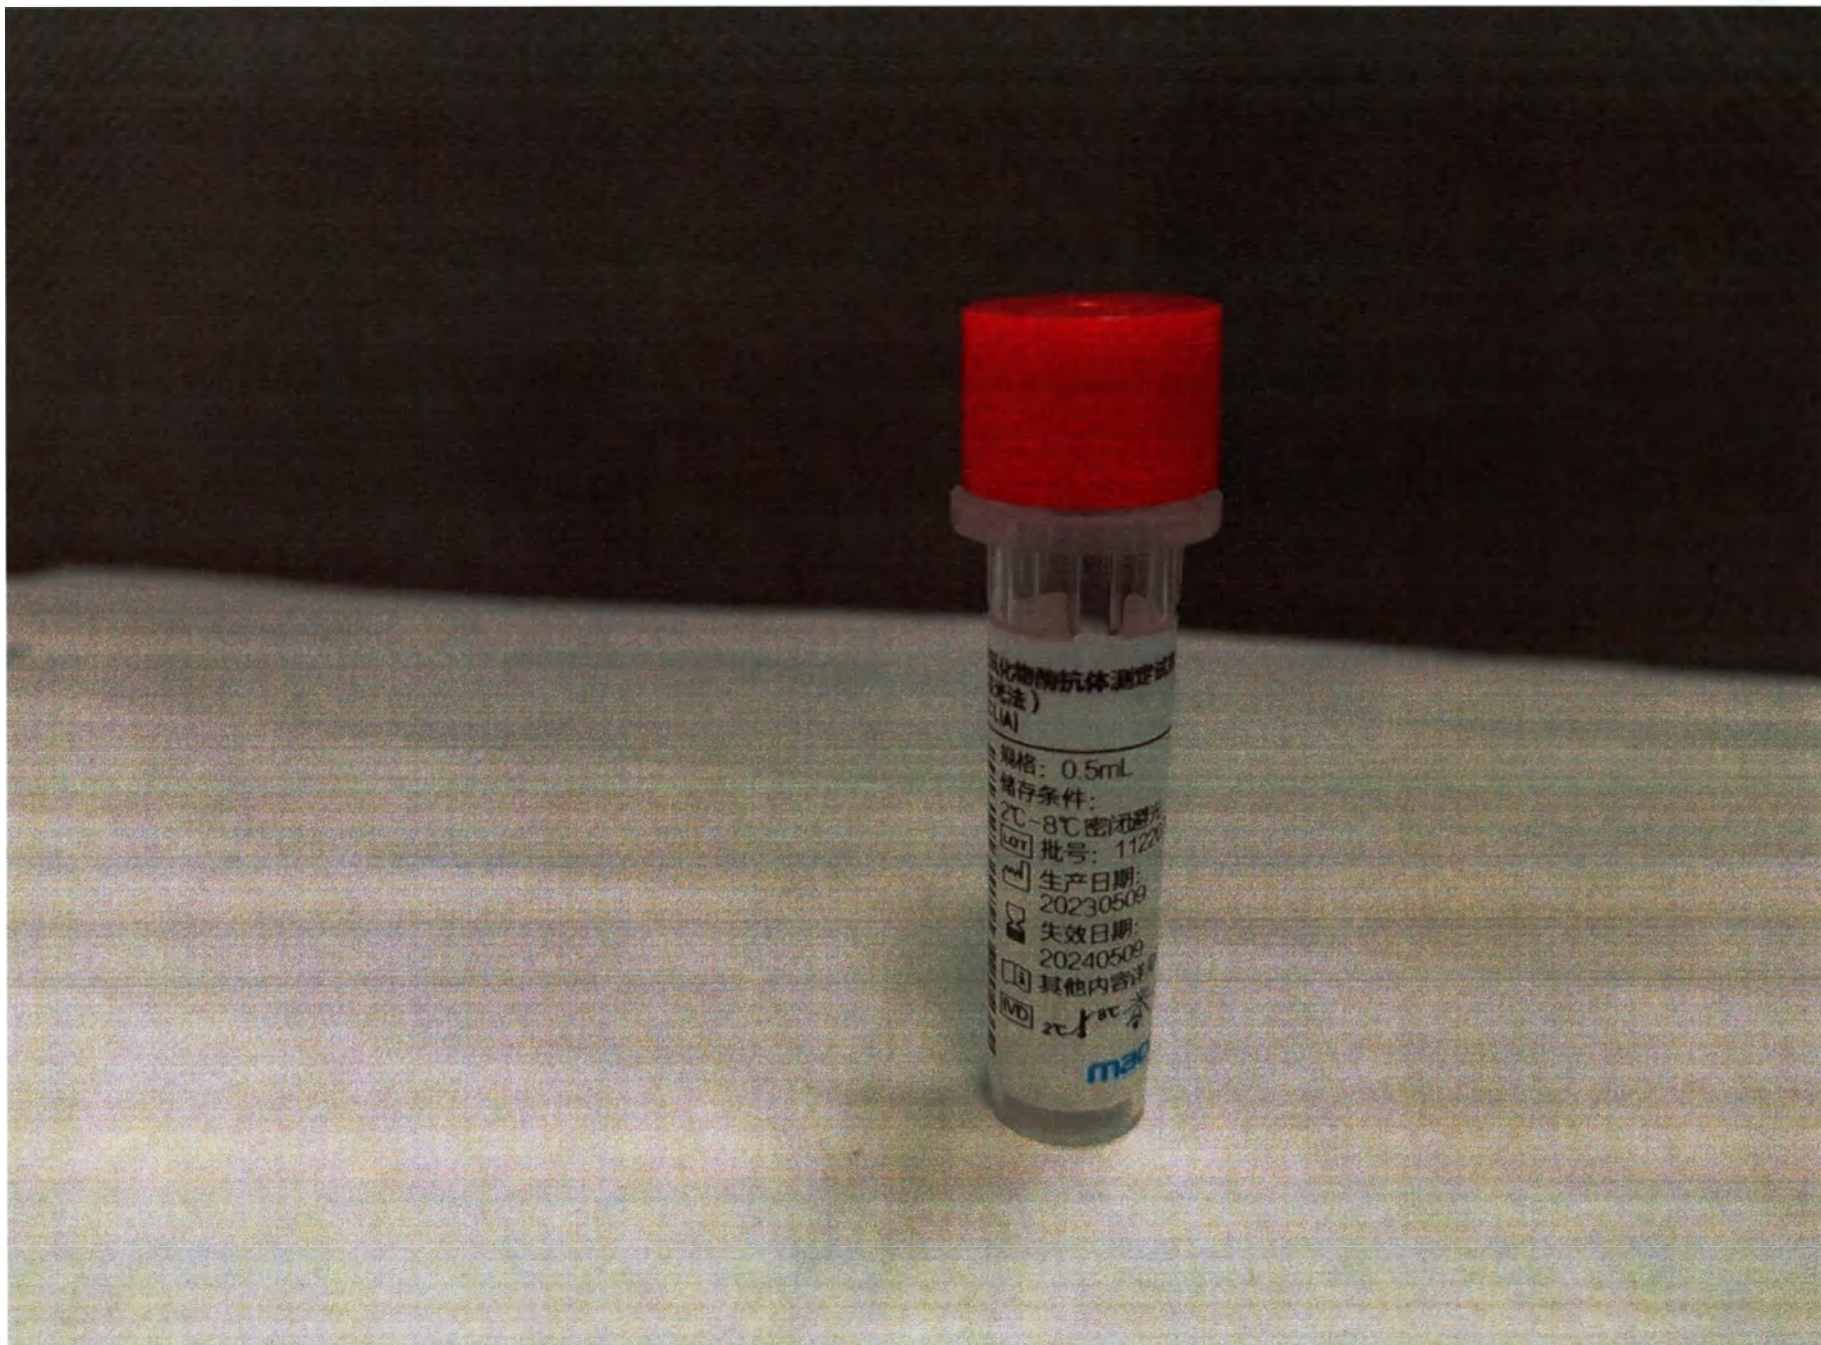

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

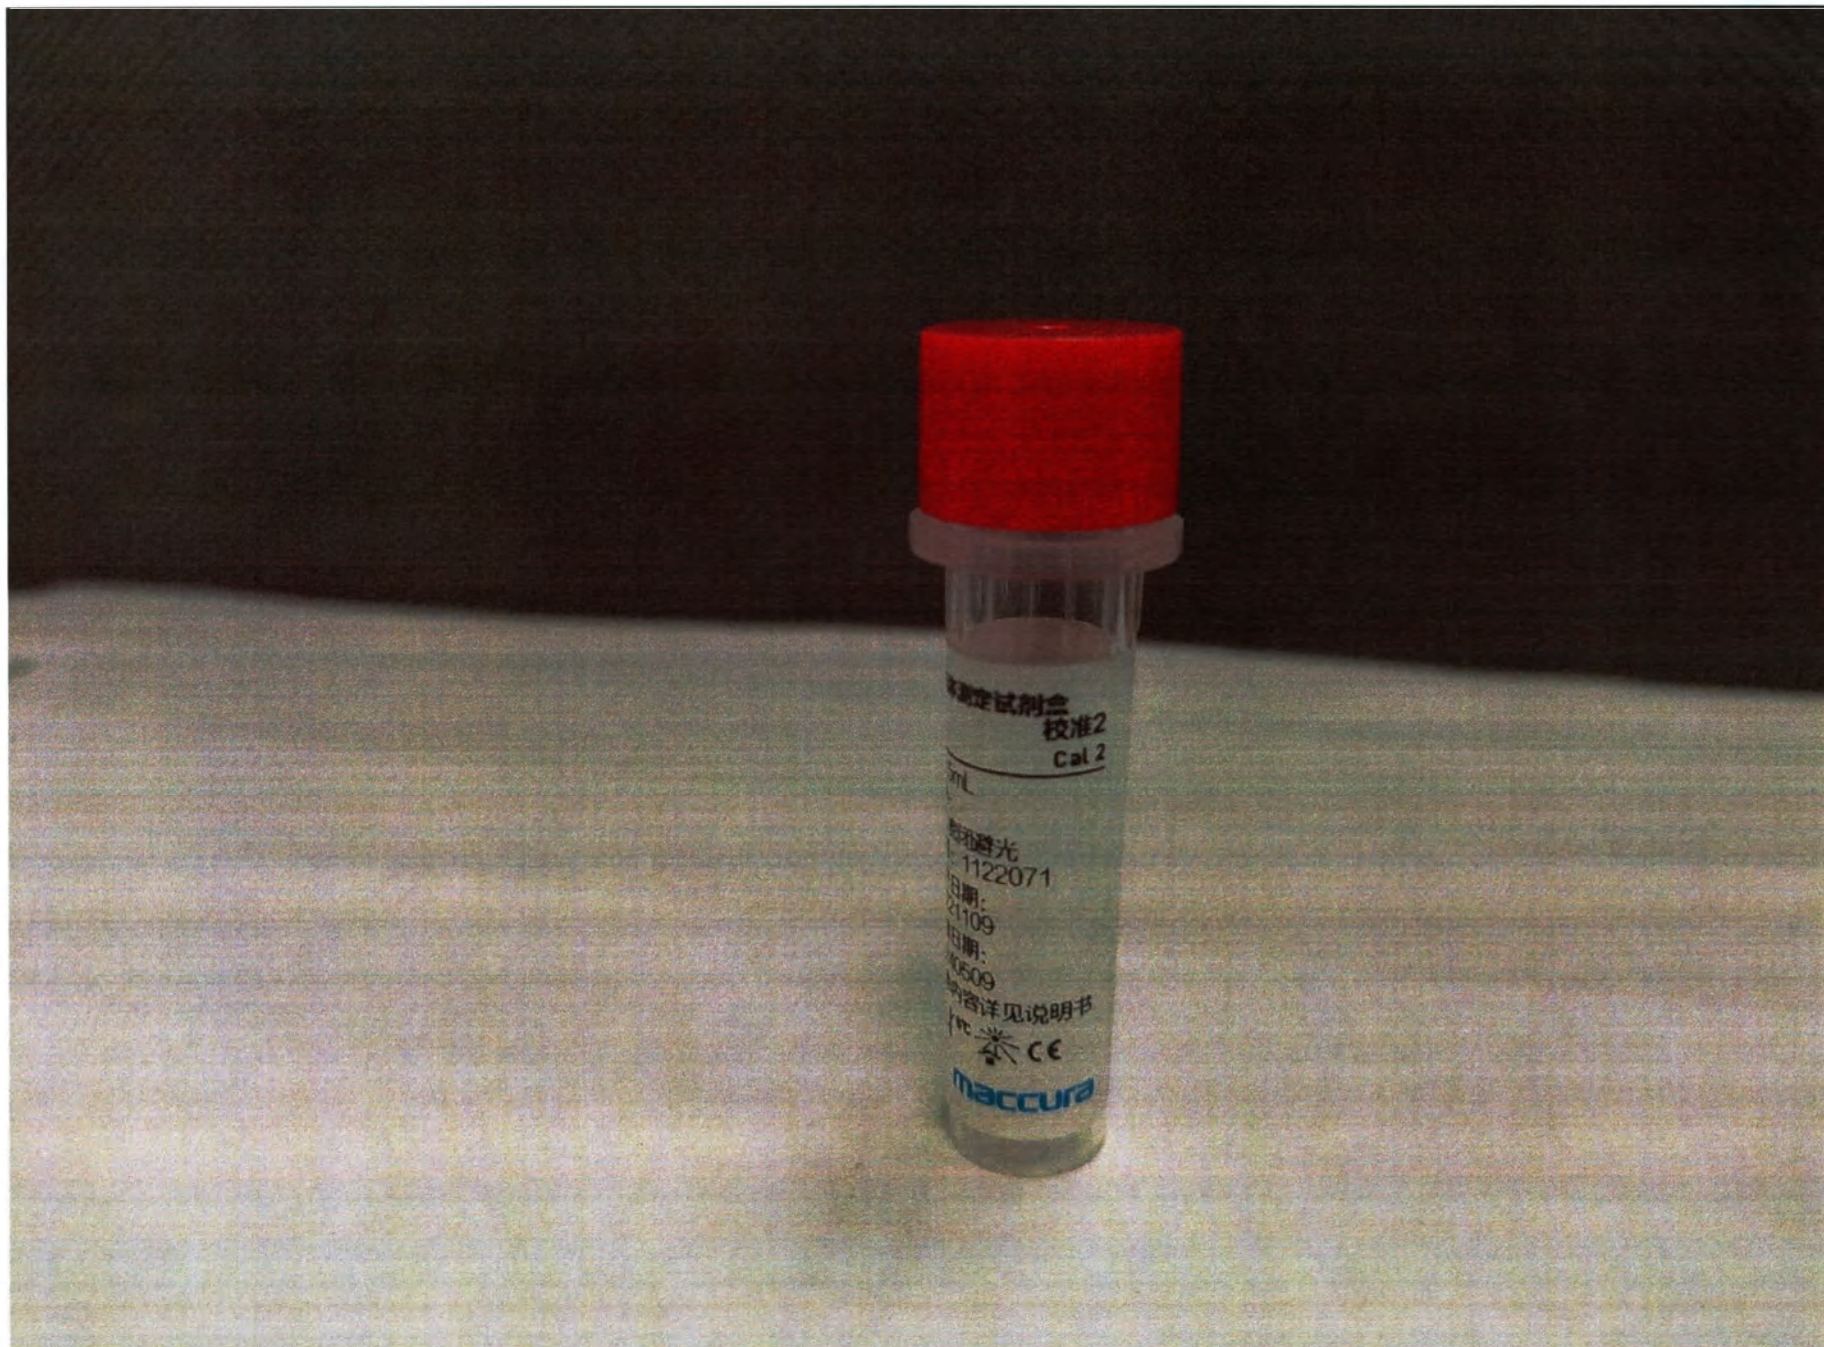

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

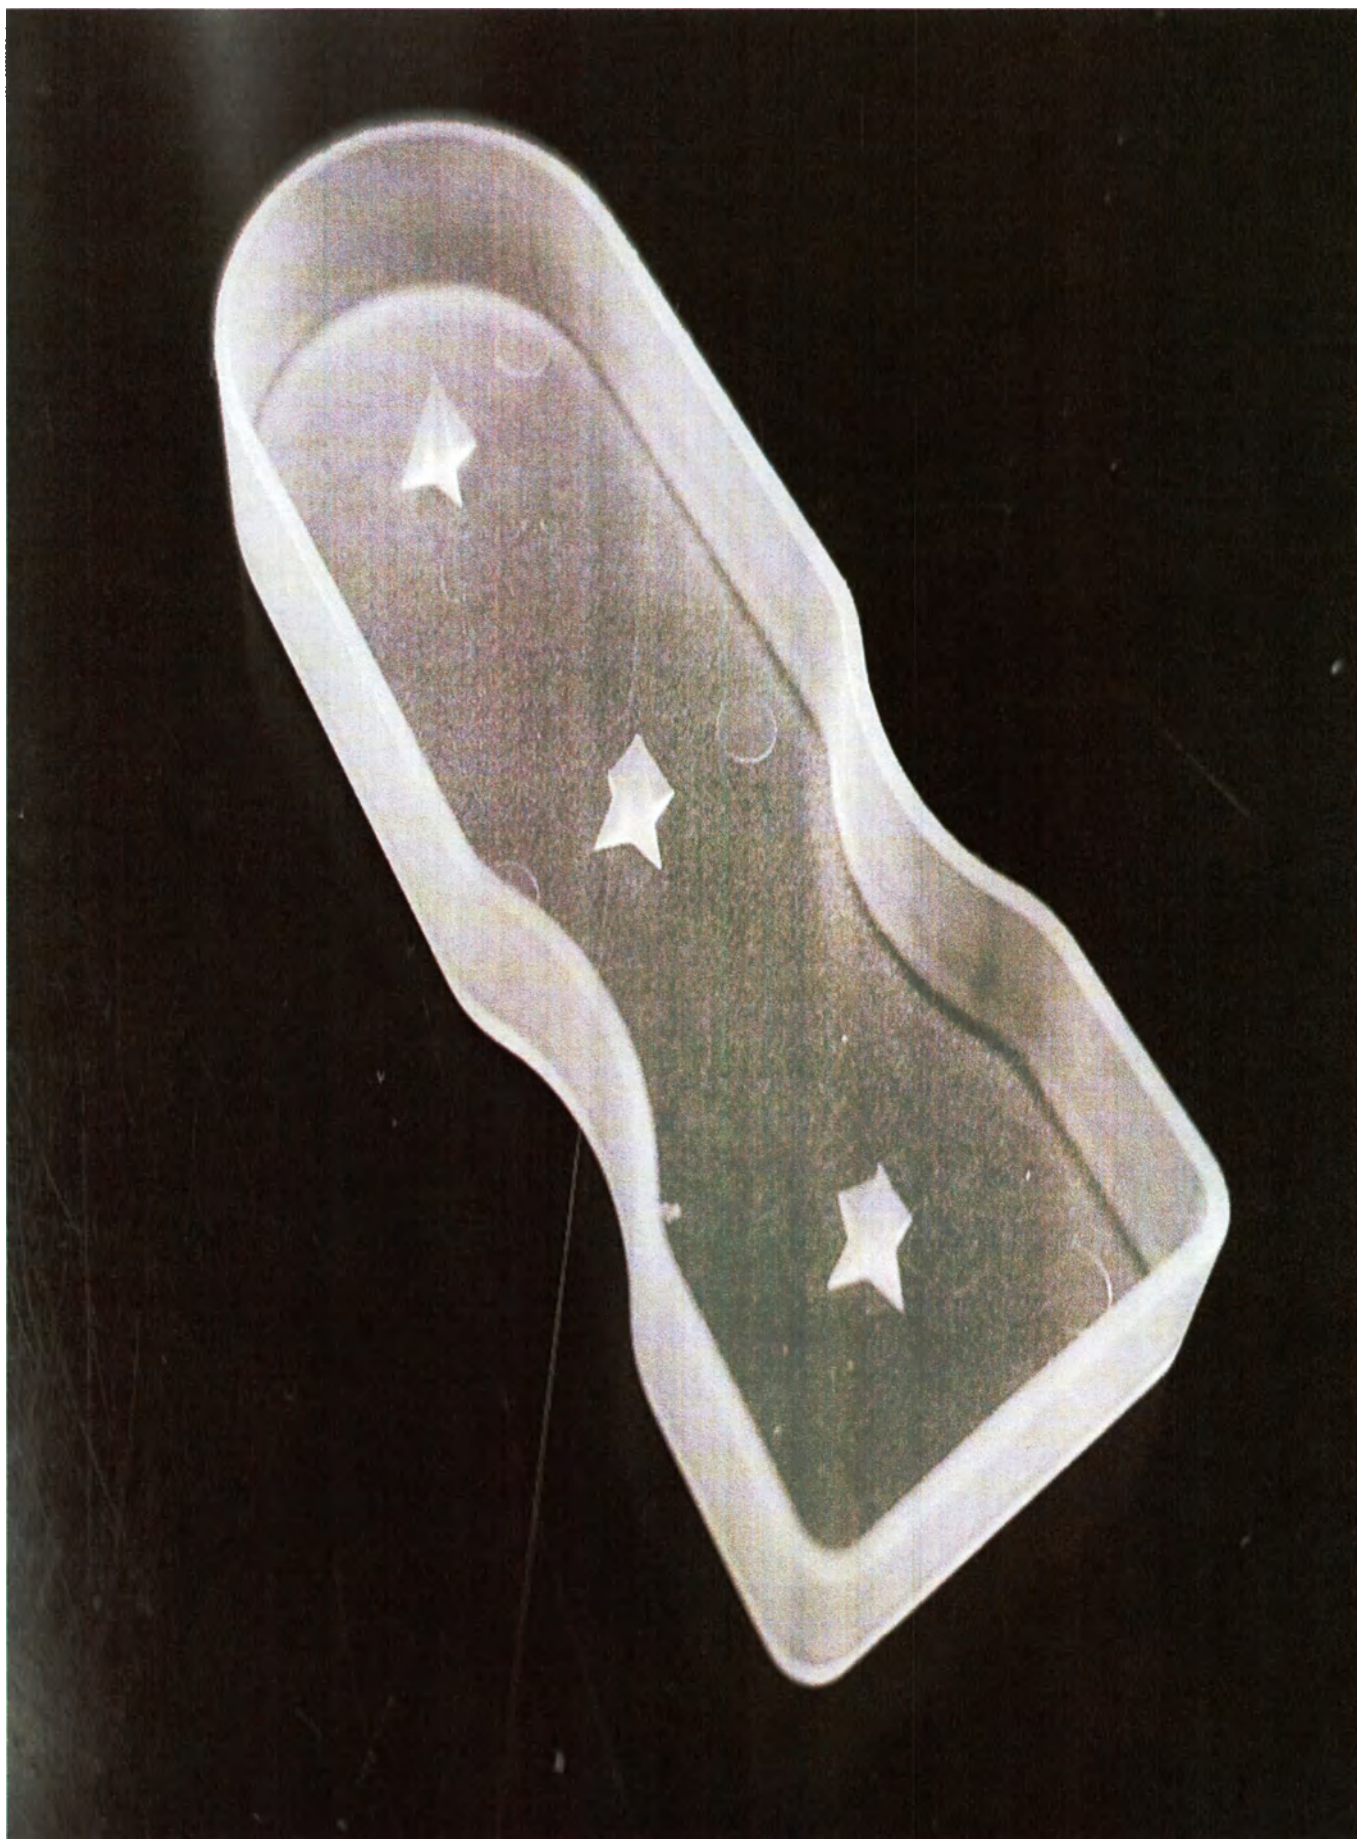

Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массуга і (Anti-TPO (CLIA)), набор на 200 тестов»

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16 листов

Р.К. Мелконьянц
Директор ООО «Эвопром»

