

ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сюн Вэй.
2023 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22г
СЫСОВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) иммунотурбидиметрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии СХ для диагностики in vitro

FDP

3x100 Tests

Fibrin(ogen) Degradation Products (FDP) Assay Kit(Immunoturbidimetry Method)

Fibrin(ojen) Yıkım Ürünleri (FDP) Tayin Kiti (İmmünoturbidimetri Yöntemi)

Kit per il dosaggio dei prodotti di degradazione della fibrina/del fibrinogeno (FDP) (metodo immunoturbidimetrico)

Kit de ensaio de produtos de degradação de fibrin(ogênio) (FDP) (método de imunoturbidimetria)

Kit de análisis de productos de degradación de la fibrina (fibrinógeno) (PDF) (método inmunoturbidimétrico)

Набор для анализа на продукты распада фибрина (фибриногена) (ПРФ) (метод имунотурбидиметрии)

Kit de dosage des produits de dégradation de fibrine (fibrinogène) (FDP) (méthode immunoturbidimétrique)

Assay-Set für Fibrin(ogen)-Abbauprodukte (FDP) (Immunoturbidimetrie)



19K062304011100011




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057 P.R.China

Tel : +86-755-81888998

Fax : +86-755-26582680

www.mindray.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany 047-042394-00(1.0)

mindray

Рисунок 1 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) имунотурбидиметрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 1)



Рисунок 2 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) иммунотурбидиметрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 2)

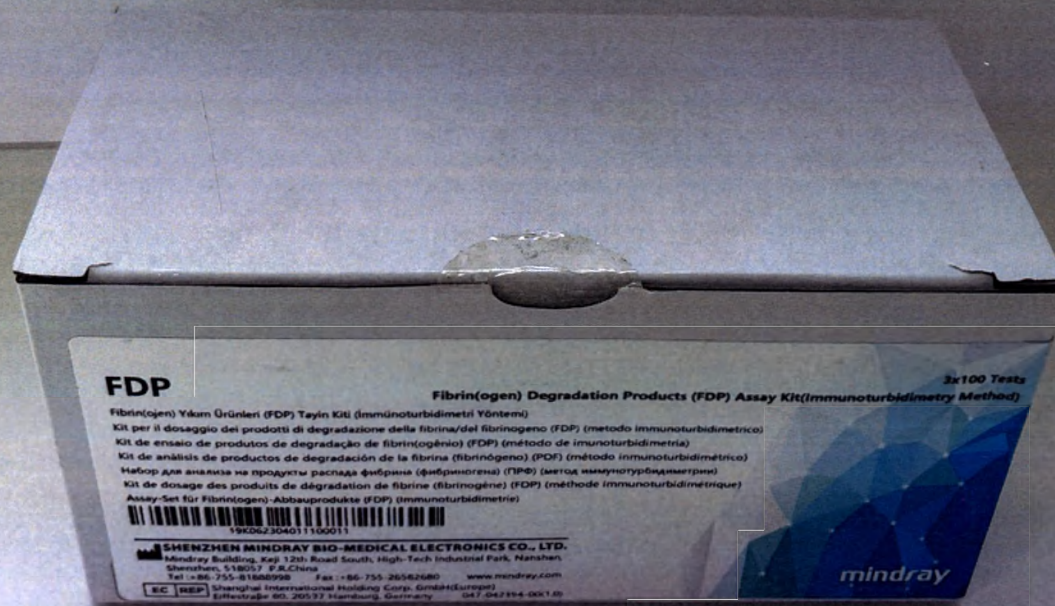


Рисунок 3 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) иммунотурбидиметрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 3)

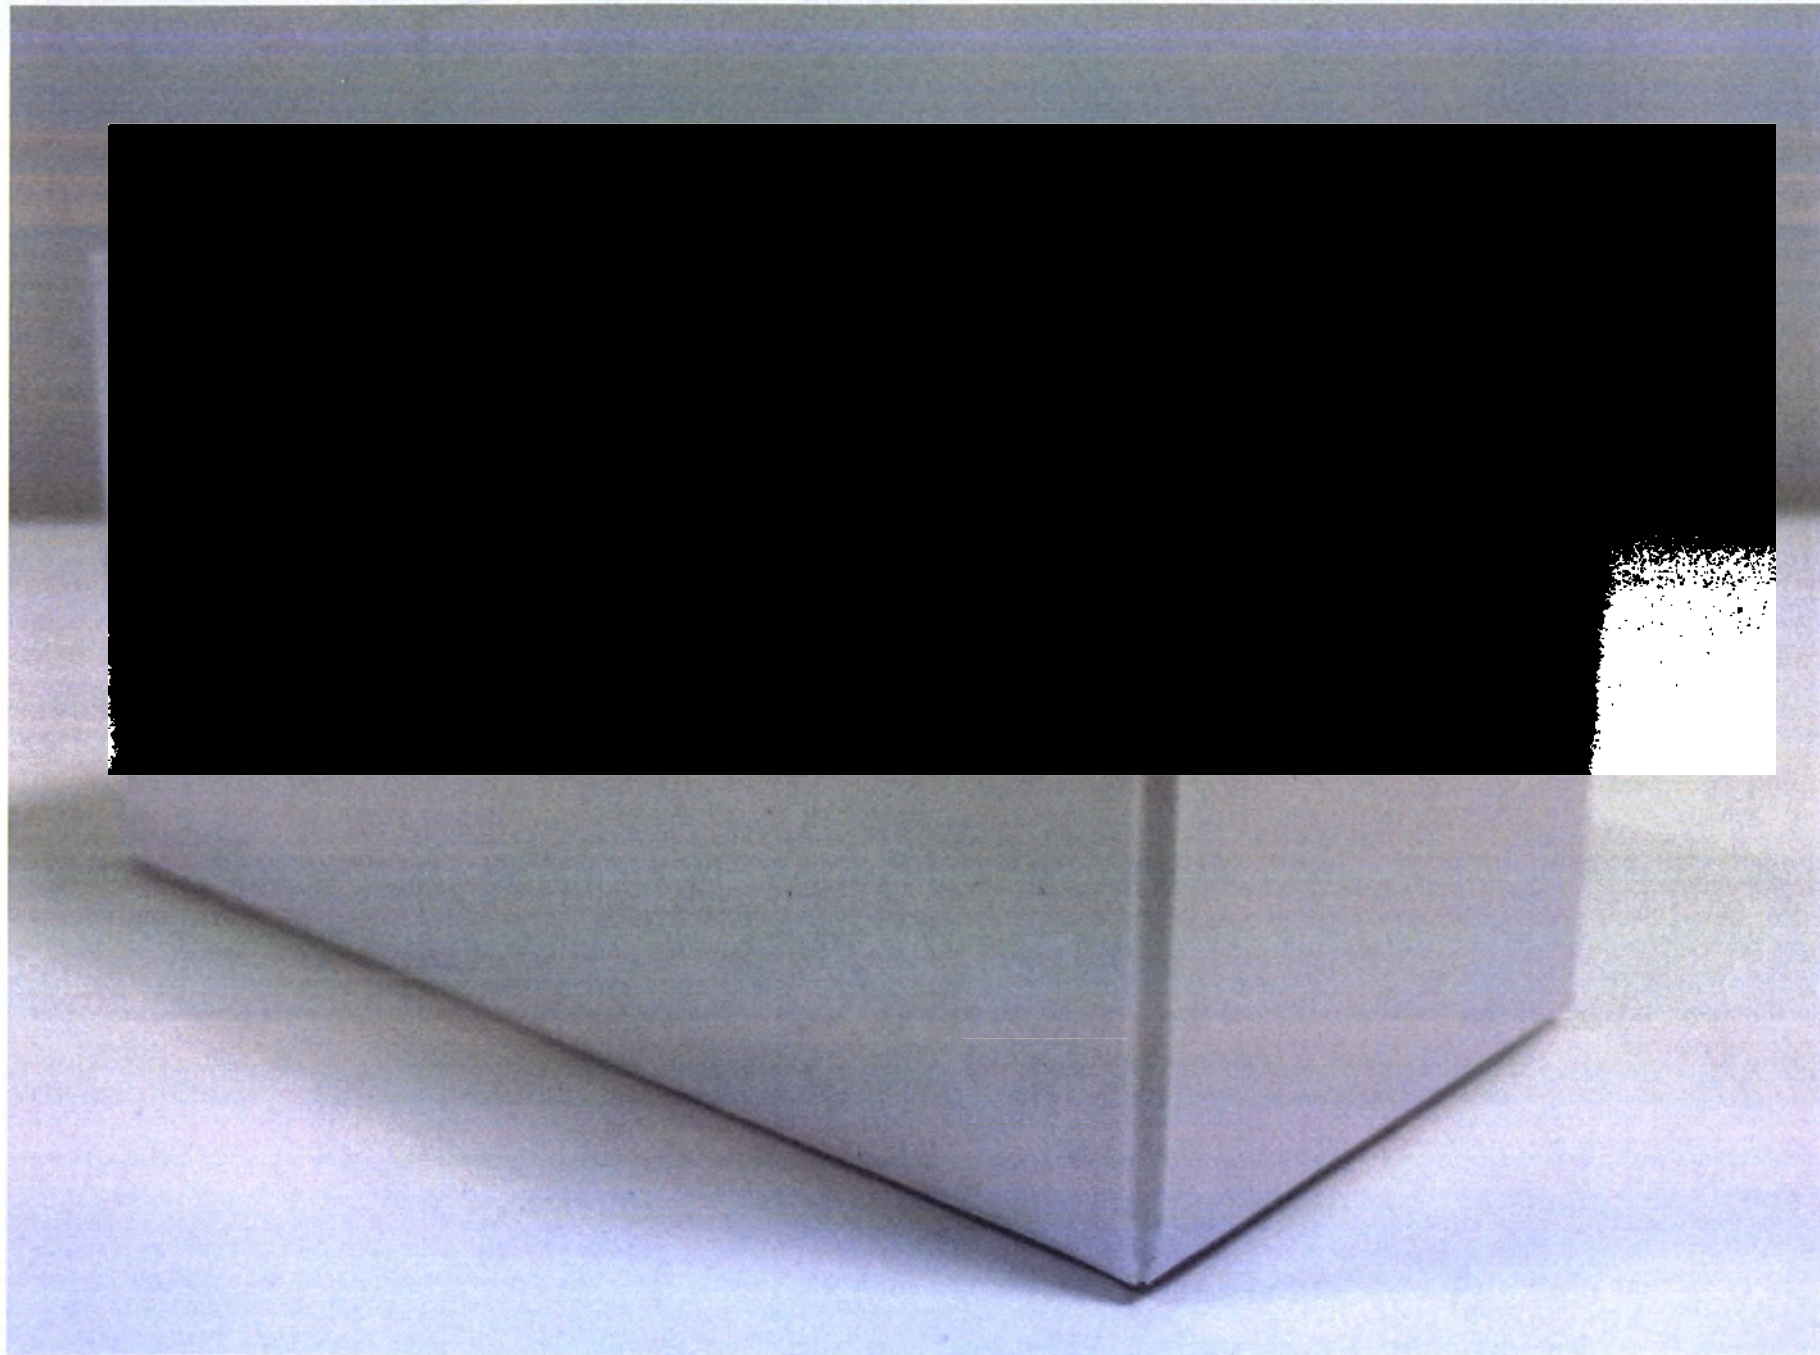


Рисунок 4 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) иммунотурбидиметрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии СХ для диагностики in vitro (вид 4)

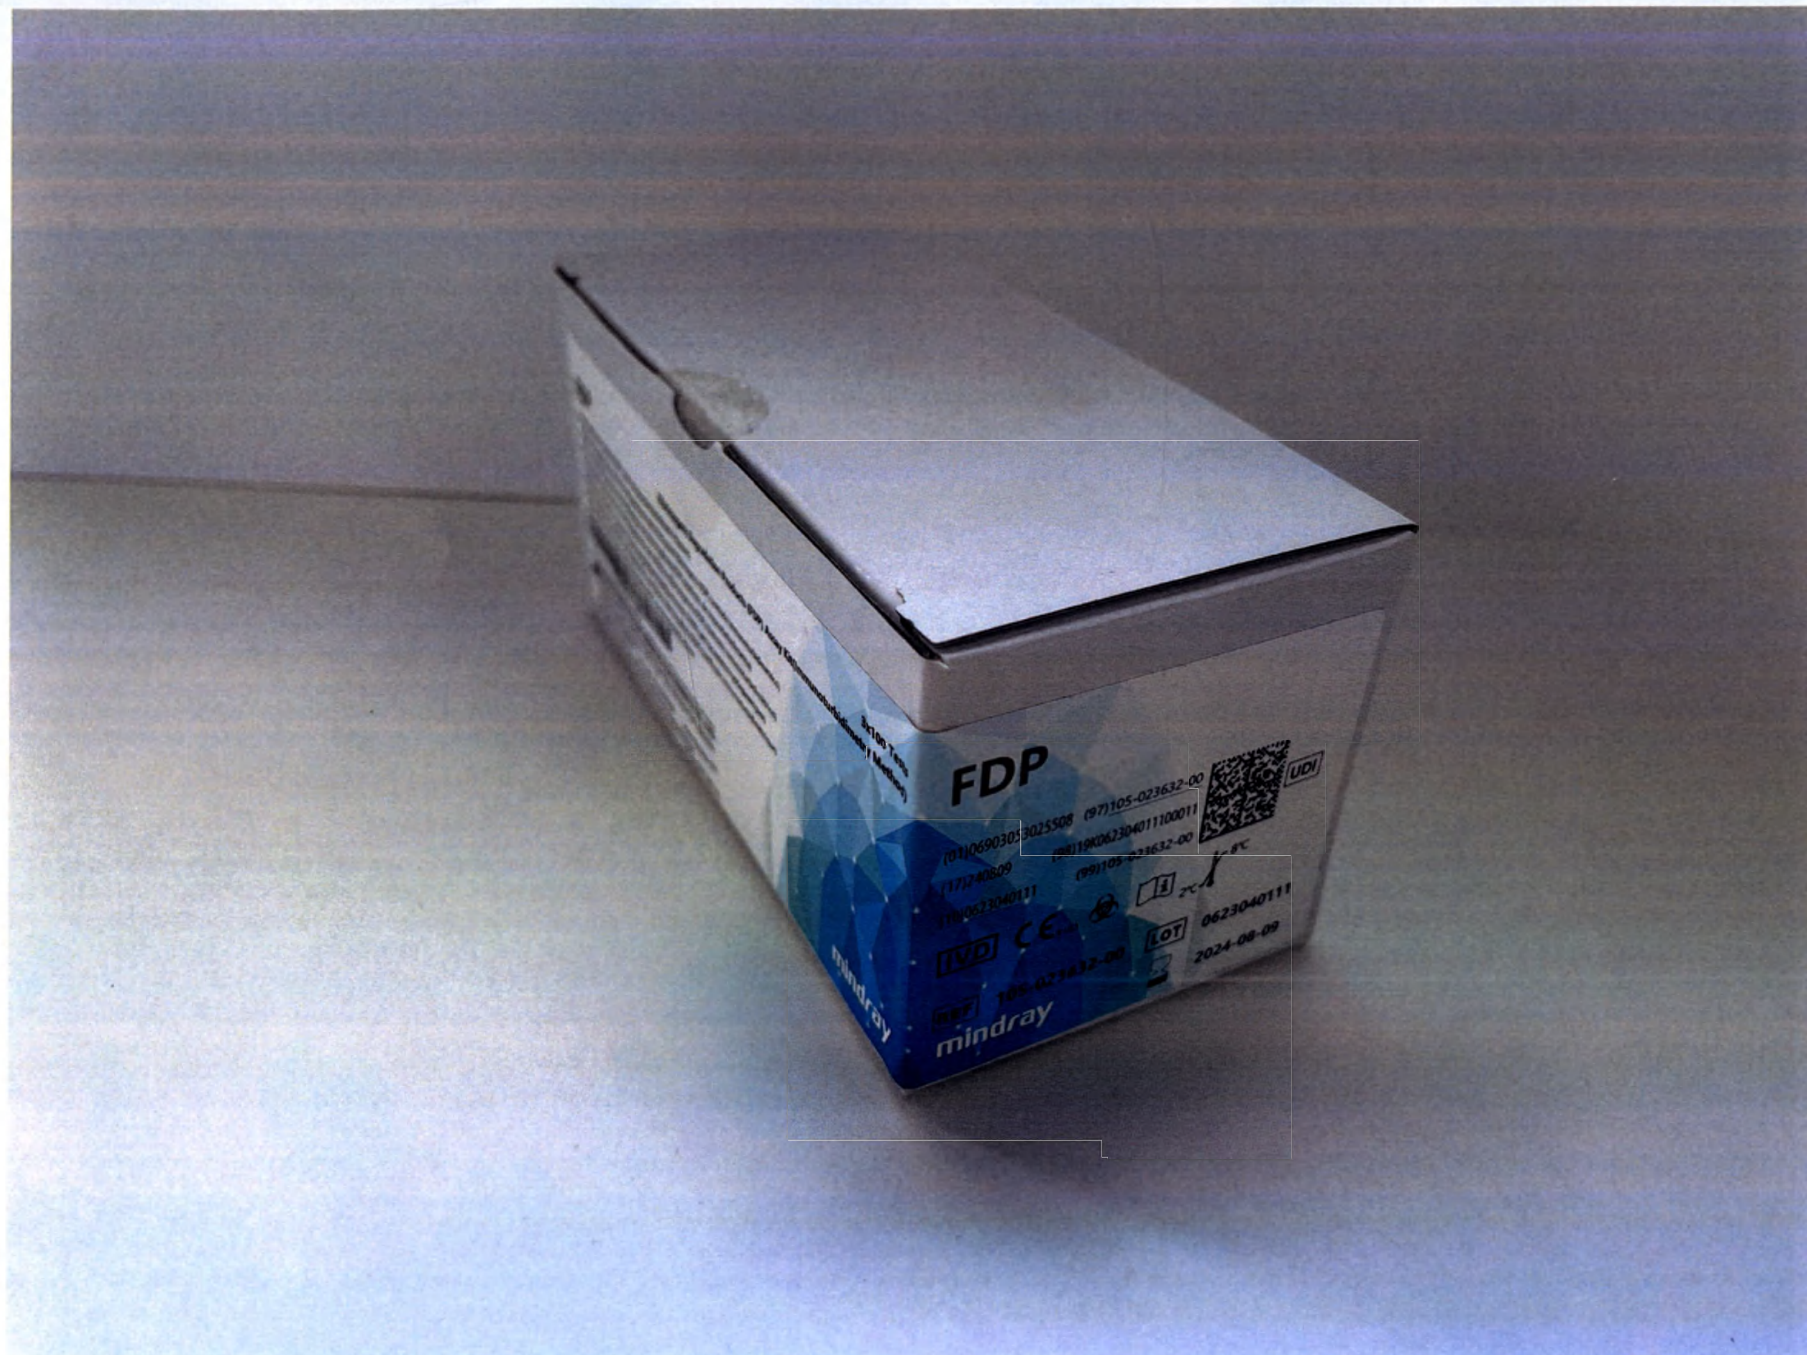


Рисунок 5 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) иммунотурбидиметрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 5)



Рисунок 6 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) иммунотурбидиметрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 6)

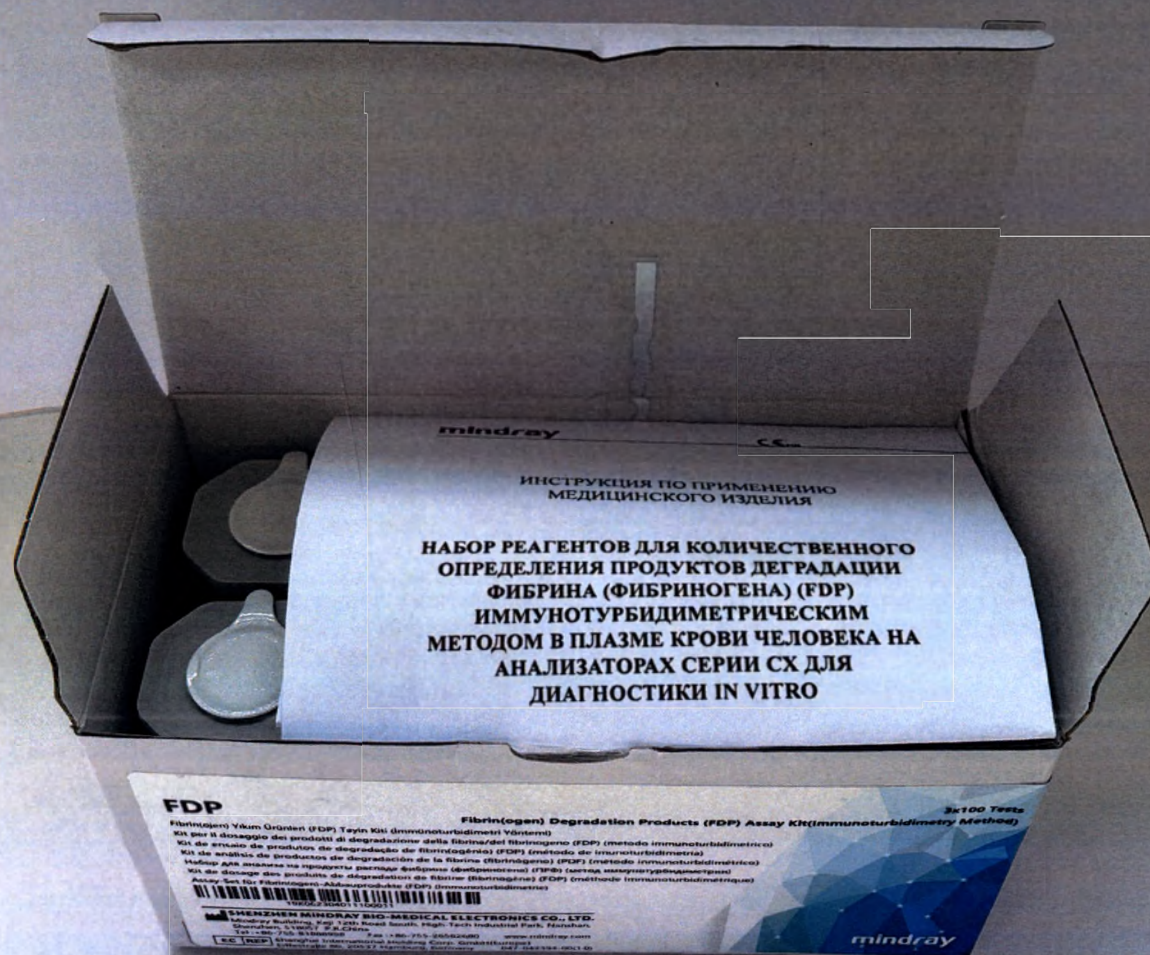


Рисунок 7 Вскрытая упаковка упаковки Набор реагентов для количественного определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) иммунотурбидиметрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 1)

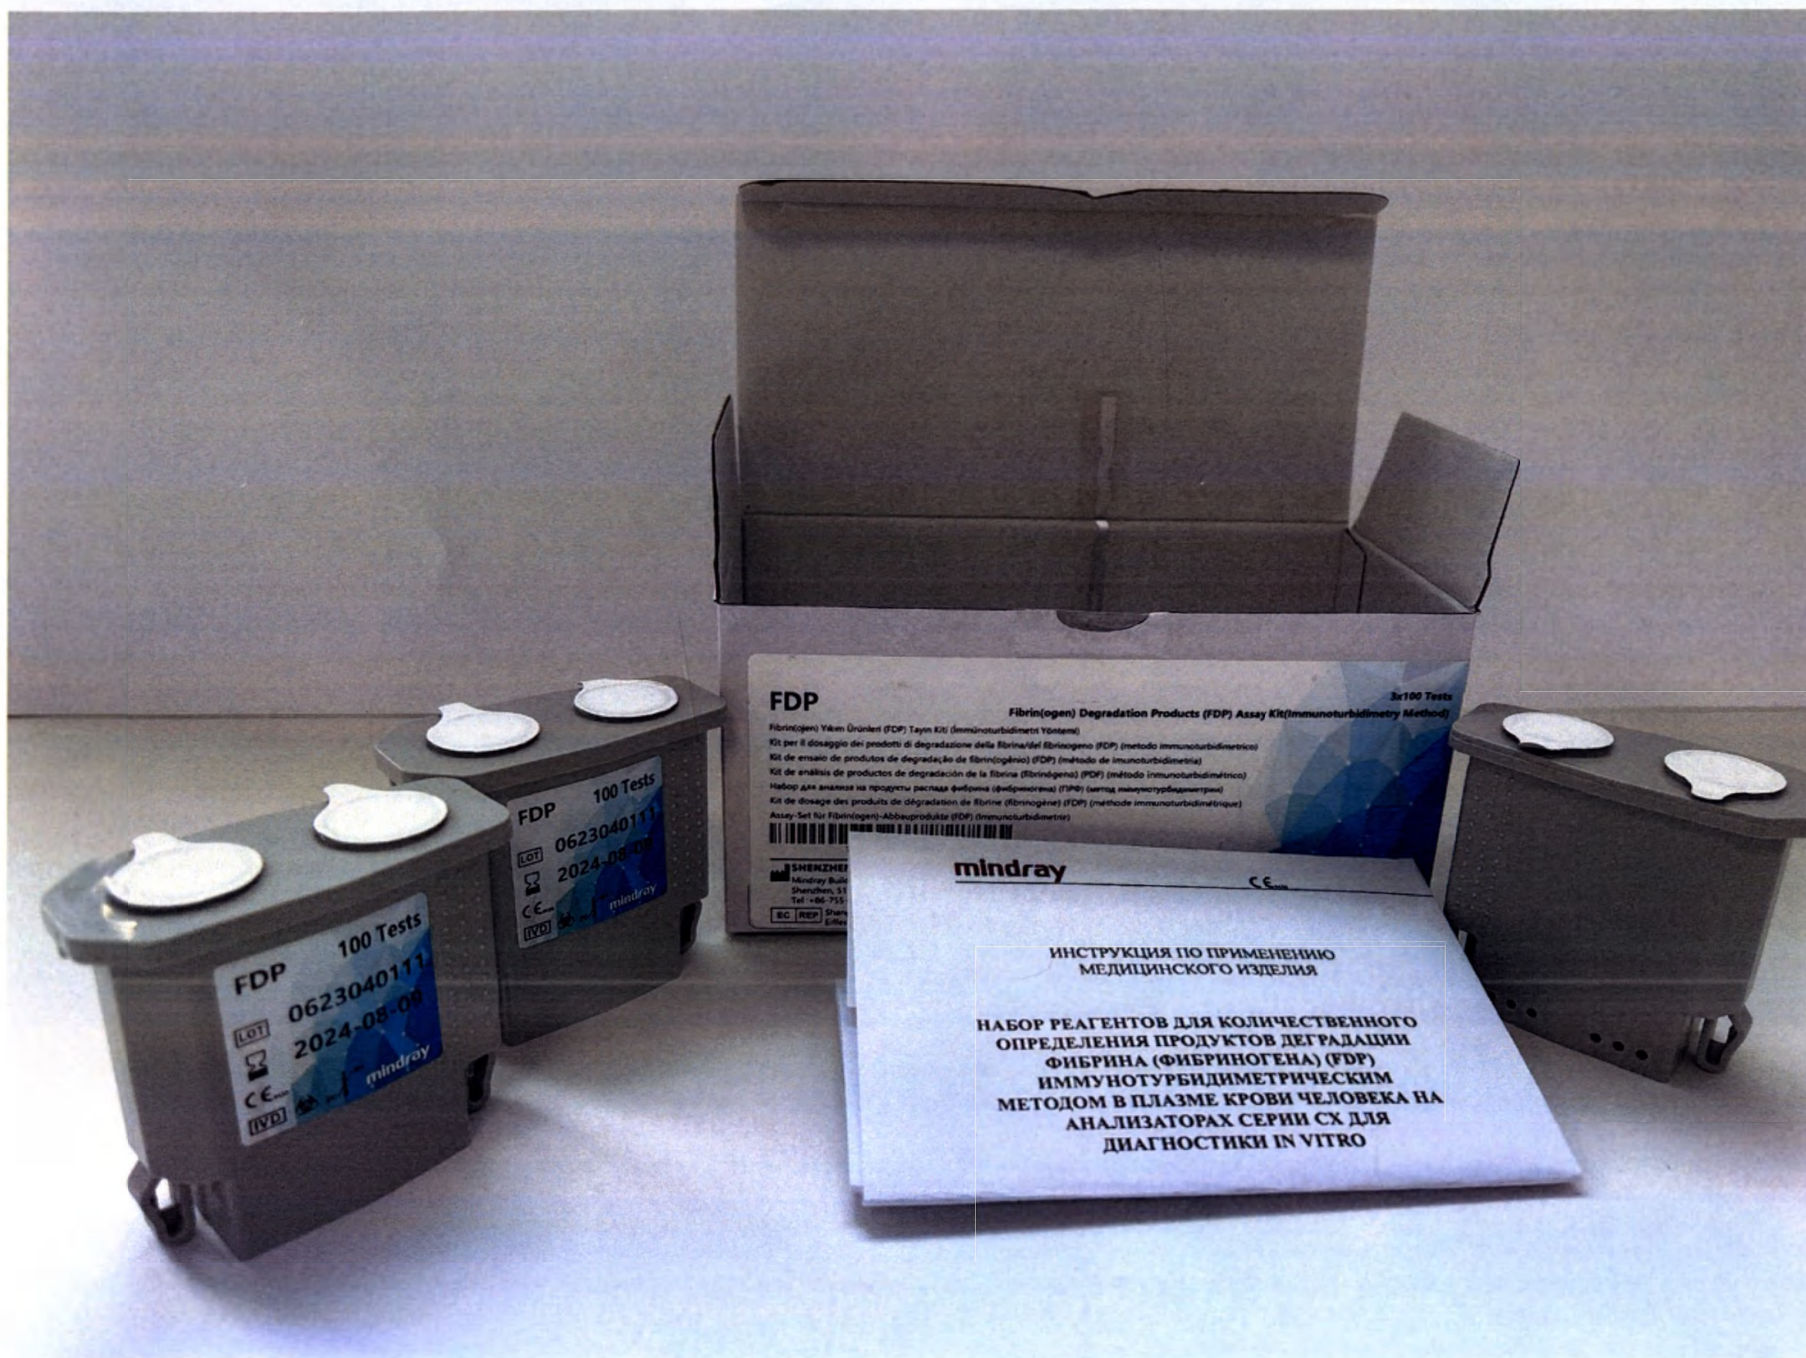


Рисунок 8 Вскрытая упаковка упаковка Набор реагентов для количественного определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) имунотурбидиметрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (вид 2)



Рисунок 9 Кассета с реагентом для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) - 3 шт x 100 тестов (вид 1)

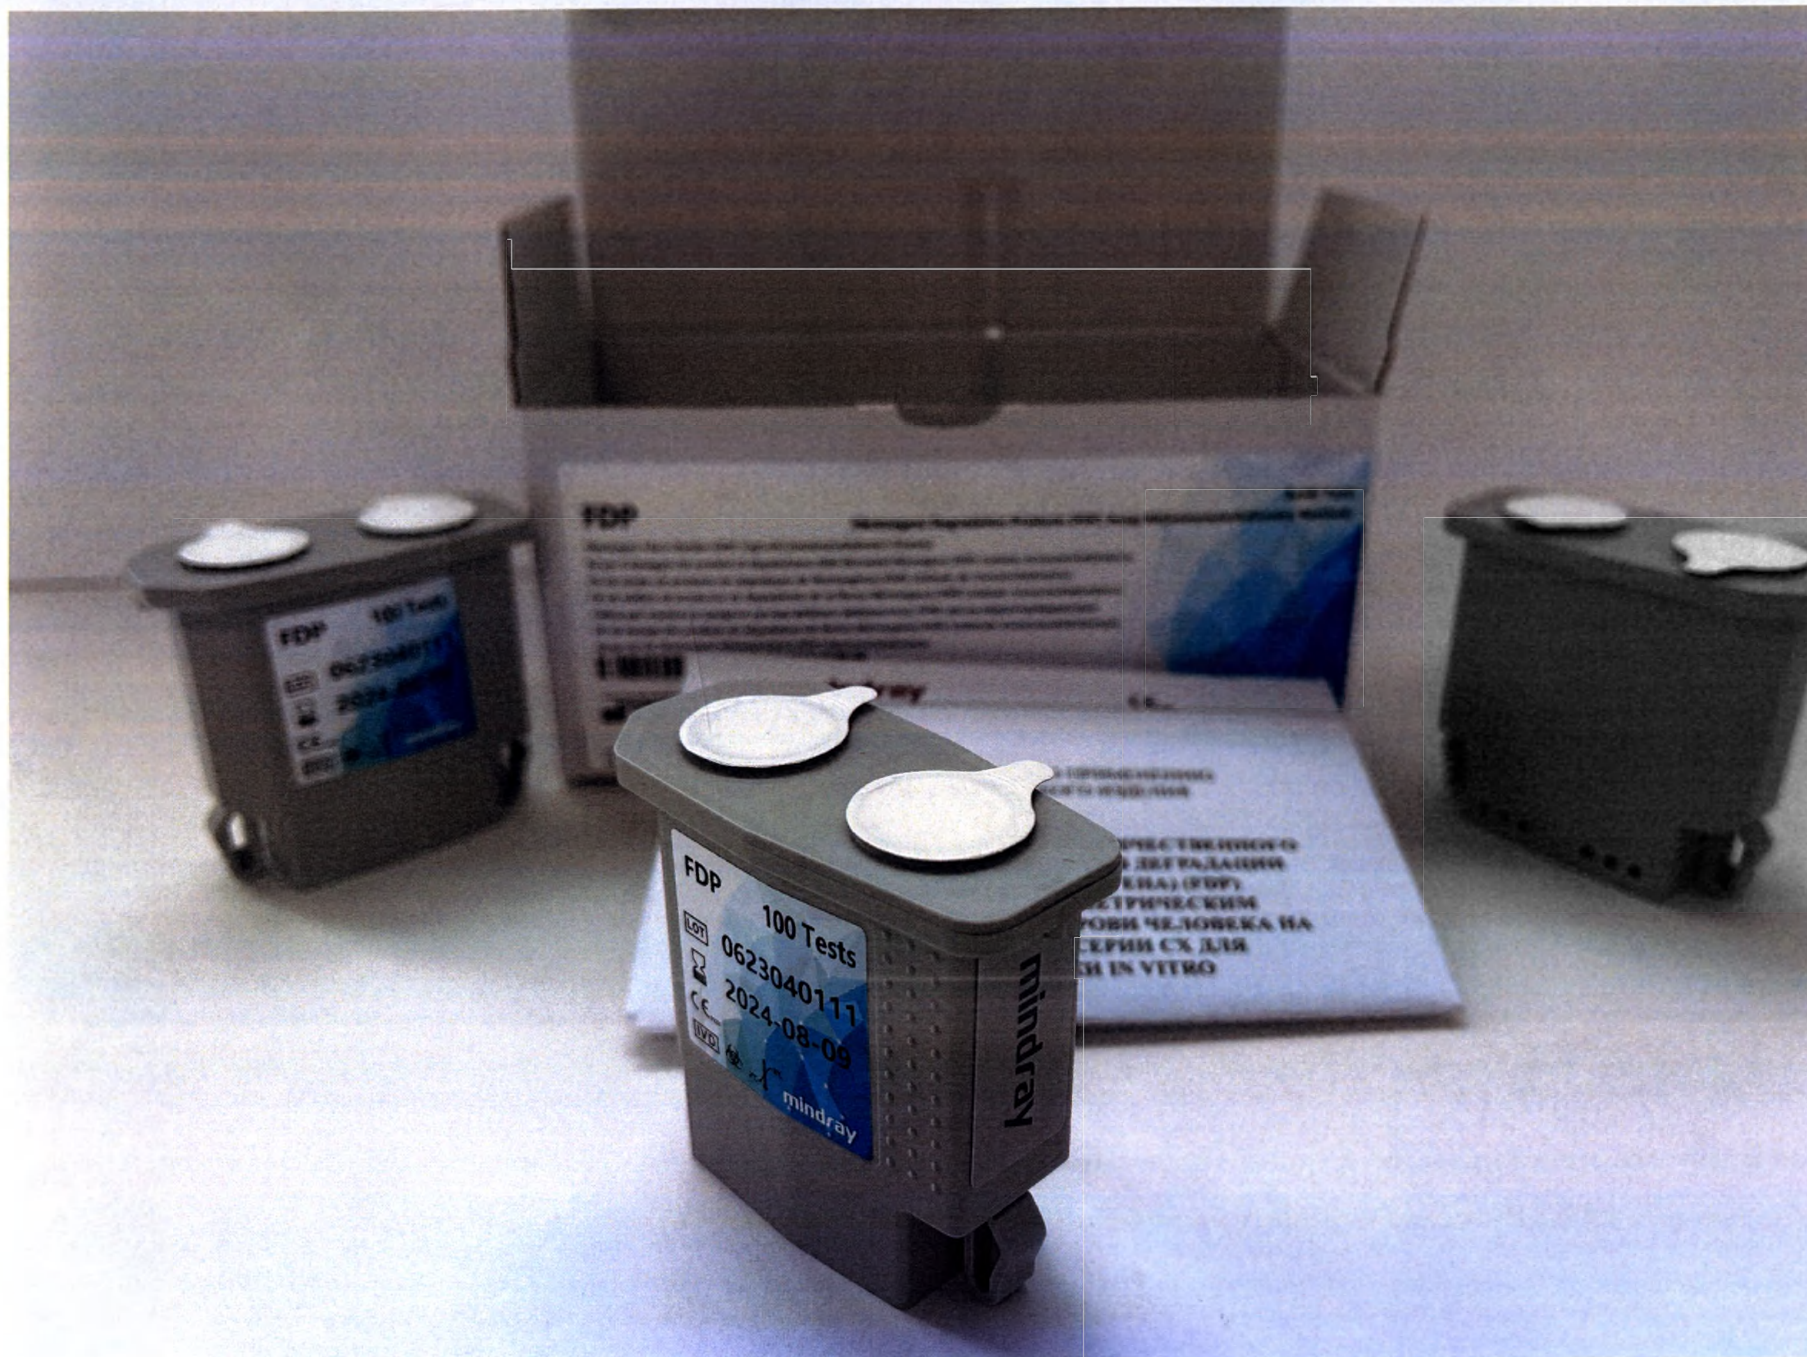


Рисунок 10 Кассета с реагентом для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) - 3 шт x 100 тестов (вид 2)

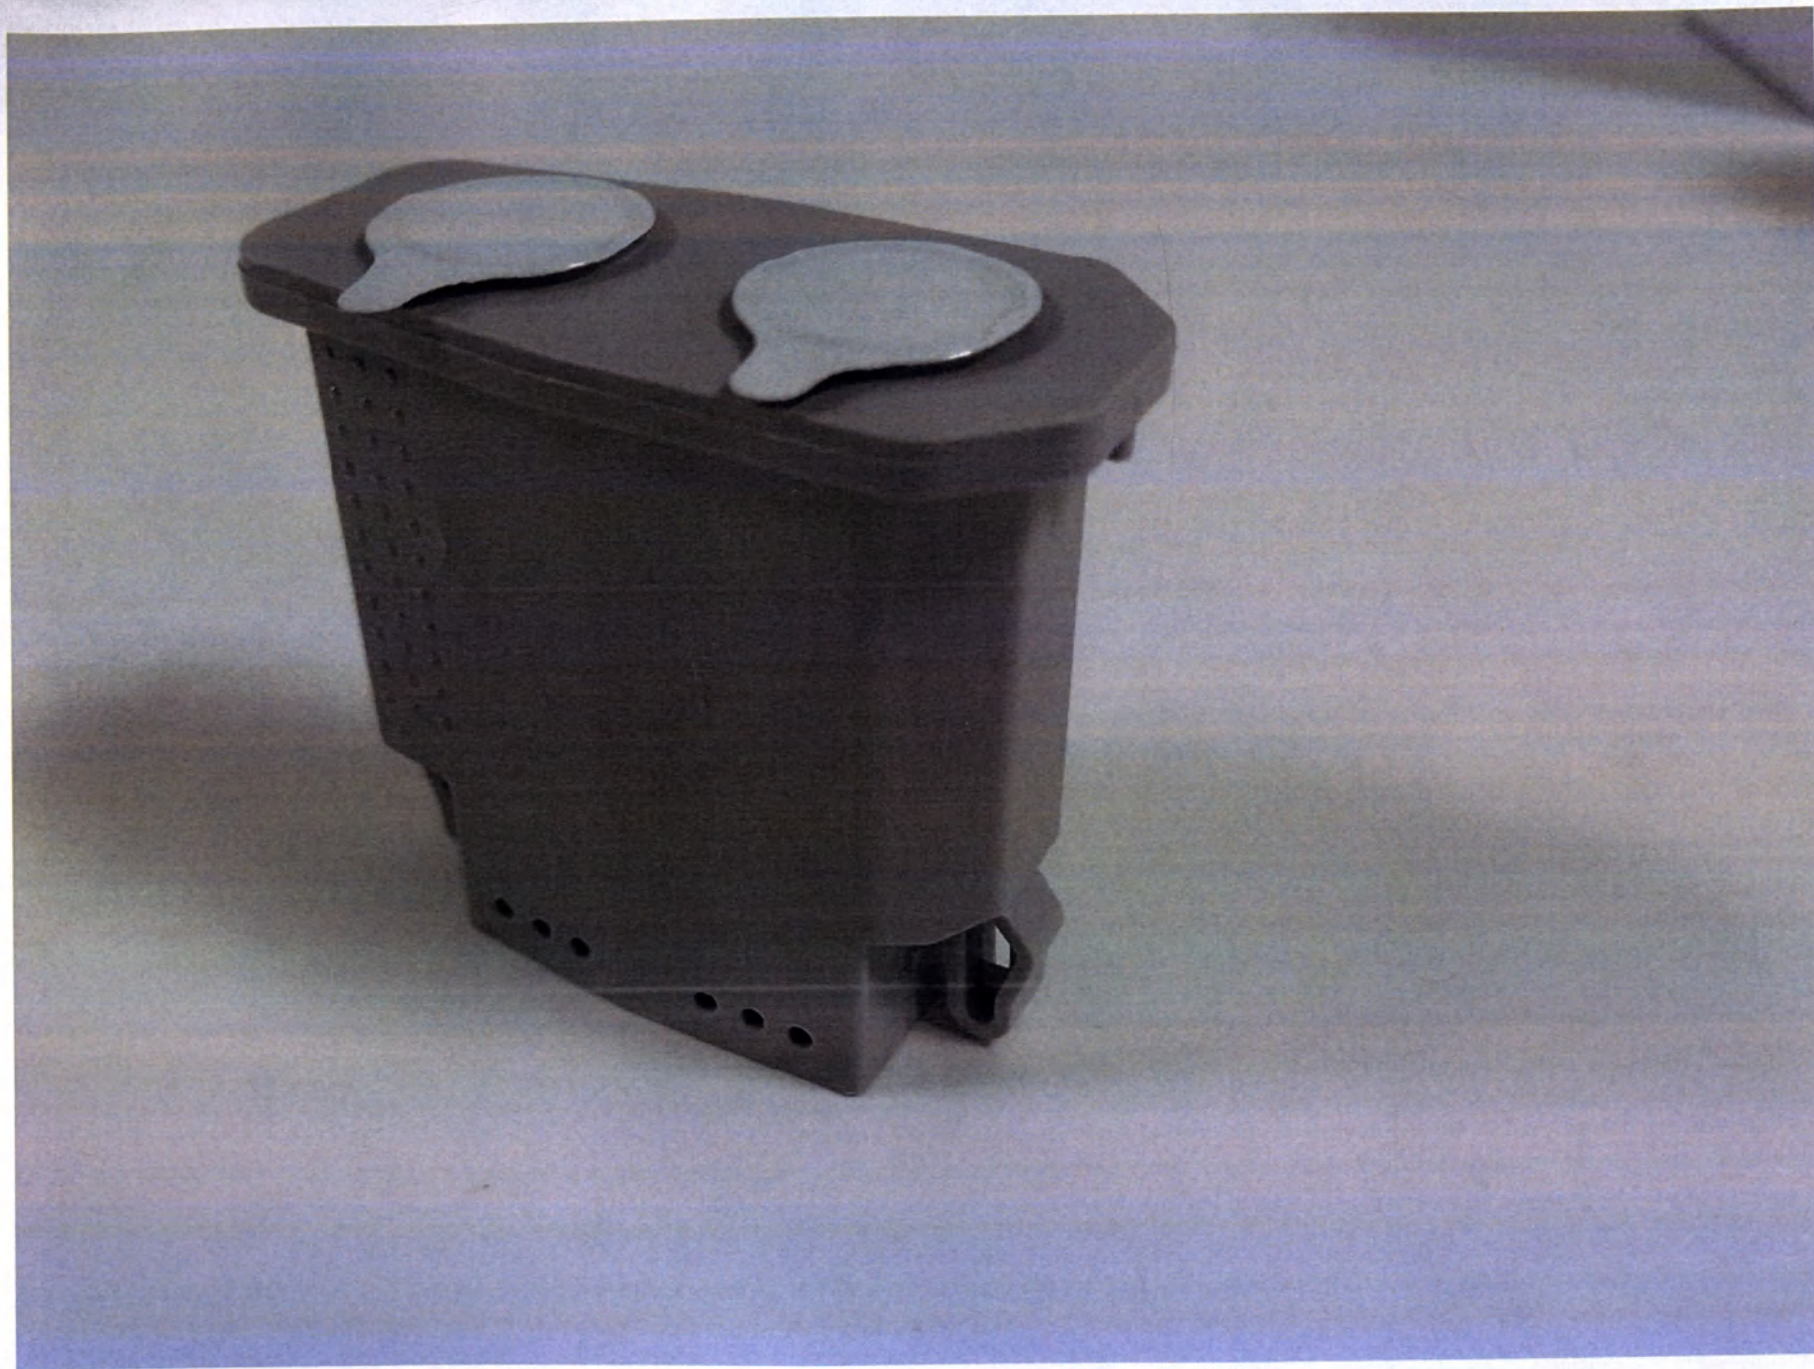


Рисунок Кассета с реагентом для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) - 3 шт x 100 тестов (вид 3)

ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
12 ЛИСТ



ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСЬОВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ