

Фотографическое изображение медицинского изделия


Кровать медицинская функциональная Centuris P750 с принадлежностями

1. Раздельные Боковые поручни с встроенными пультами управления-пара (SplitSiderails -Pair)
2. Раздельные Боковые поручни без встроенных пультов управления - пара (SplitSiderailsw/o integrated controls-Pair)
3. Головная спинка (Headboard)
4. Ножная спинка (Footboard)
5. Угловой амортизатор- 4 шт. (Cornerbumpers-4)
6. 4 электромотора постоянного тока (FourDCmotors)
7. Педаль тормоза или переключатель тормоза/управления в ножной секции (Four-cornerbrakepedalorfoot-endbrakeandsteerbar)
8. Подвесной пульт управления (Hand-held pendant control)
9. Рукоятка перевода в положение для СЛР- 2 шт. (EmergencyCPRhandle-2)
10. Ролики, 12,5 см- 4 шт.(Casters, 12.5 cm- 4)
11. Педаль центрального тормоза и управления (Centralbrakeandsteer)
12. Матрас противопролежневыйHillRomNP50 (ASS028) 198 cmx 90 cmx 14 cm (Foam pressure reduction mattress Hill Rom NP50 (ASS028) 198 cm x 90 cm x 14 cm)
13. Матрас противопролежневыйHillRomNP50 (P50A7F) 203.2 cmx 90.2 cmx 15.2 cm(Foam pressure reduction mattress Hill Rom Mattress NP50 (P50A7F) 203.2 cm x 90.2 cm x 15.2 cm)
14. Матрас противопролежневыйHillRomNP100 (ASS031) 198 cmx 90 cmx 14 cm(Foam pressure reduction mattress Hill Rom NP100 (ASS031) 198 cm x 90 cm x 14 cm)
15. Матрас противопролежневыйHillRomNP100 (P100A4) 203.2 cmx 90.2 cmx 15.2 cm(Foam pressure reduction mattress Hill Rom NP100 (P100A4) 203.2 cm x 90.2 cm x 15.2 cm)
16. Матрас противопролежневыйHillRomNP150 (ASS034) 198 cmx 90 cmx 14 cm(Foam pressure reduction mattress Hill Rom NP150 (ASS034) 198 cm x 90 cm x 14 cm)
17. Матрас противопролежневый P564CA3 Basic, Nylon Ticking203.2 cm x 90.2 cm x 15.2 cm(Mattress P564CA3 Basic, Nylon Ticking203.2 cm x 90.2 cm x 15.2 cm)
18. Матрас противопролежневыйP709CB1 Shearless, 203.2 cmx 90.2 cmx 15.2 cm(Mattress P709CB1 Shearless, pressure reduction203.2 cm x 90.2 cm x 15.2 cm)
- 19.Съемная инфузионная стойка (Removable IV pole)
20. Съемная инфузионная стойка (выносная)(RemovableIVpole (offsetstyle)
- 21.Держатель кислородного баллона (Oxygen tank holder)
22. Система поддержки пациента с рукояткой (Patienthelperwithhandle)
- 23.Рама для вытяжения (Traction frame)
- 24.Удлинитель матраса (Mattressextender)
- 25.Механизм удлинения кровати (Bedextender)


Организации-изготовители

1. HILL-ROM SERVICES, Private Limited,1 YISHUN AVE 7,SINGAPORE 768923
2. Optima Healthcare Inc., Mingzhu development area, HeYuan City Guangdong Province, China



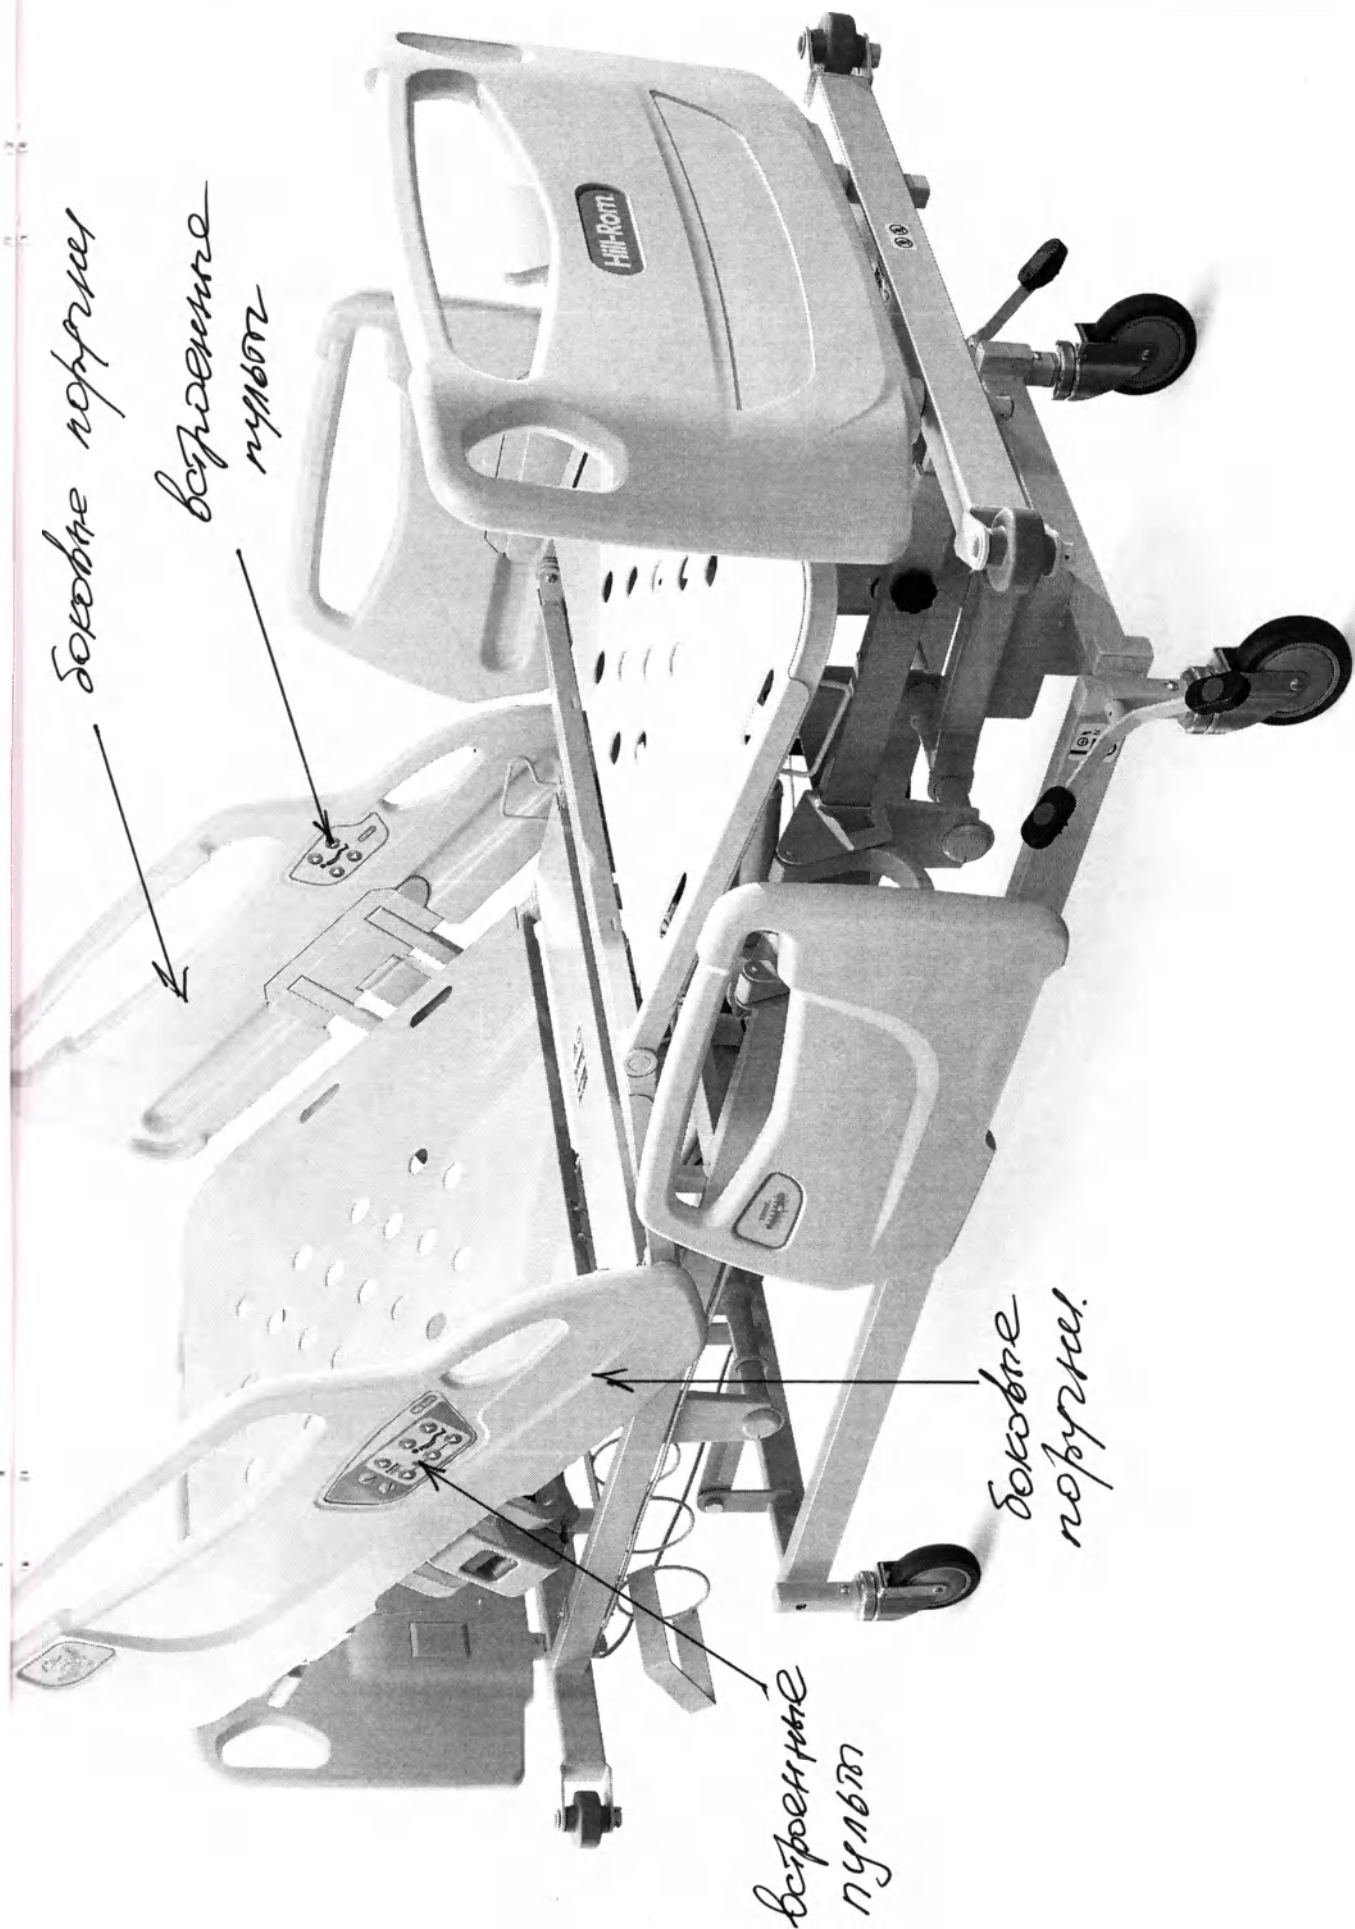

1. Раздельные боковые поручни с встроенными ручками управления

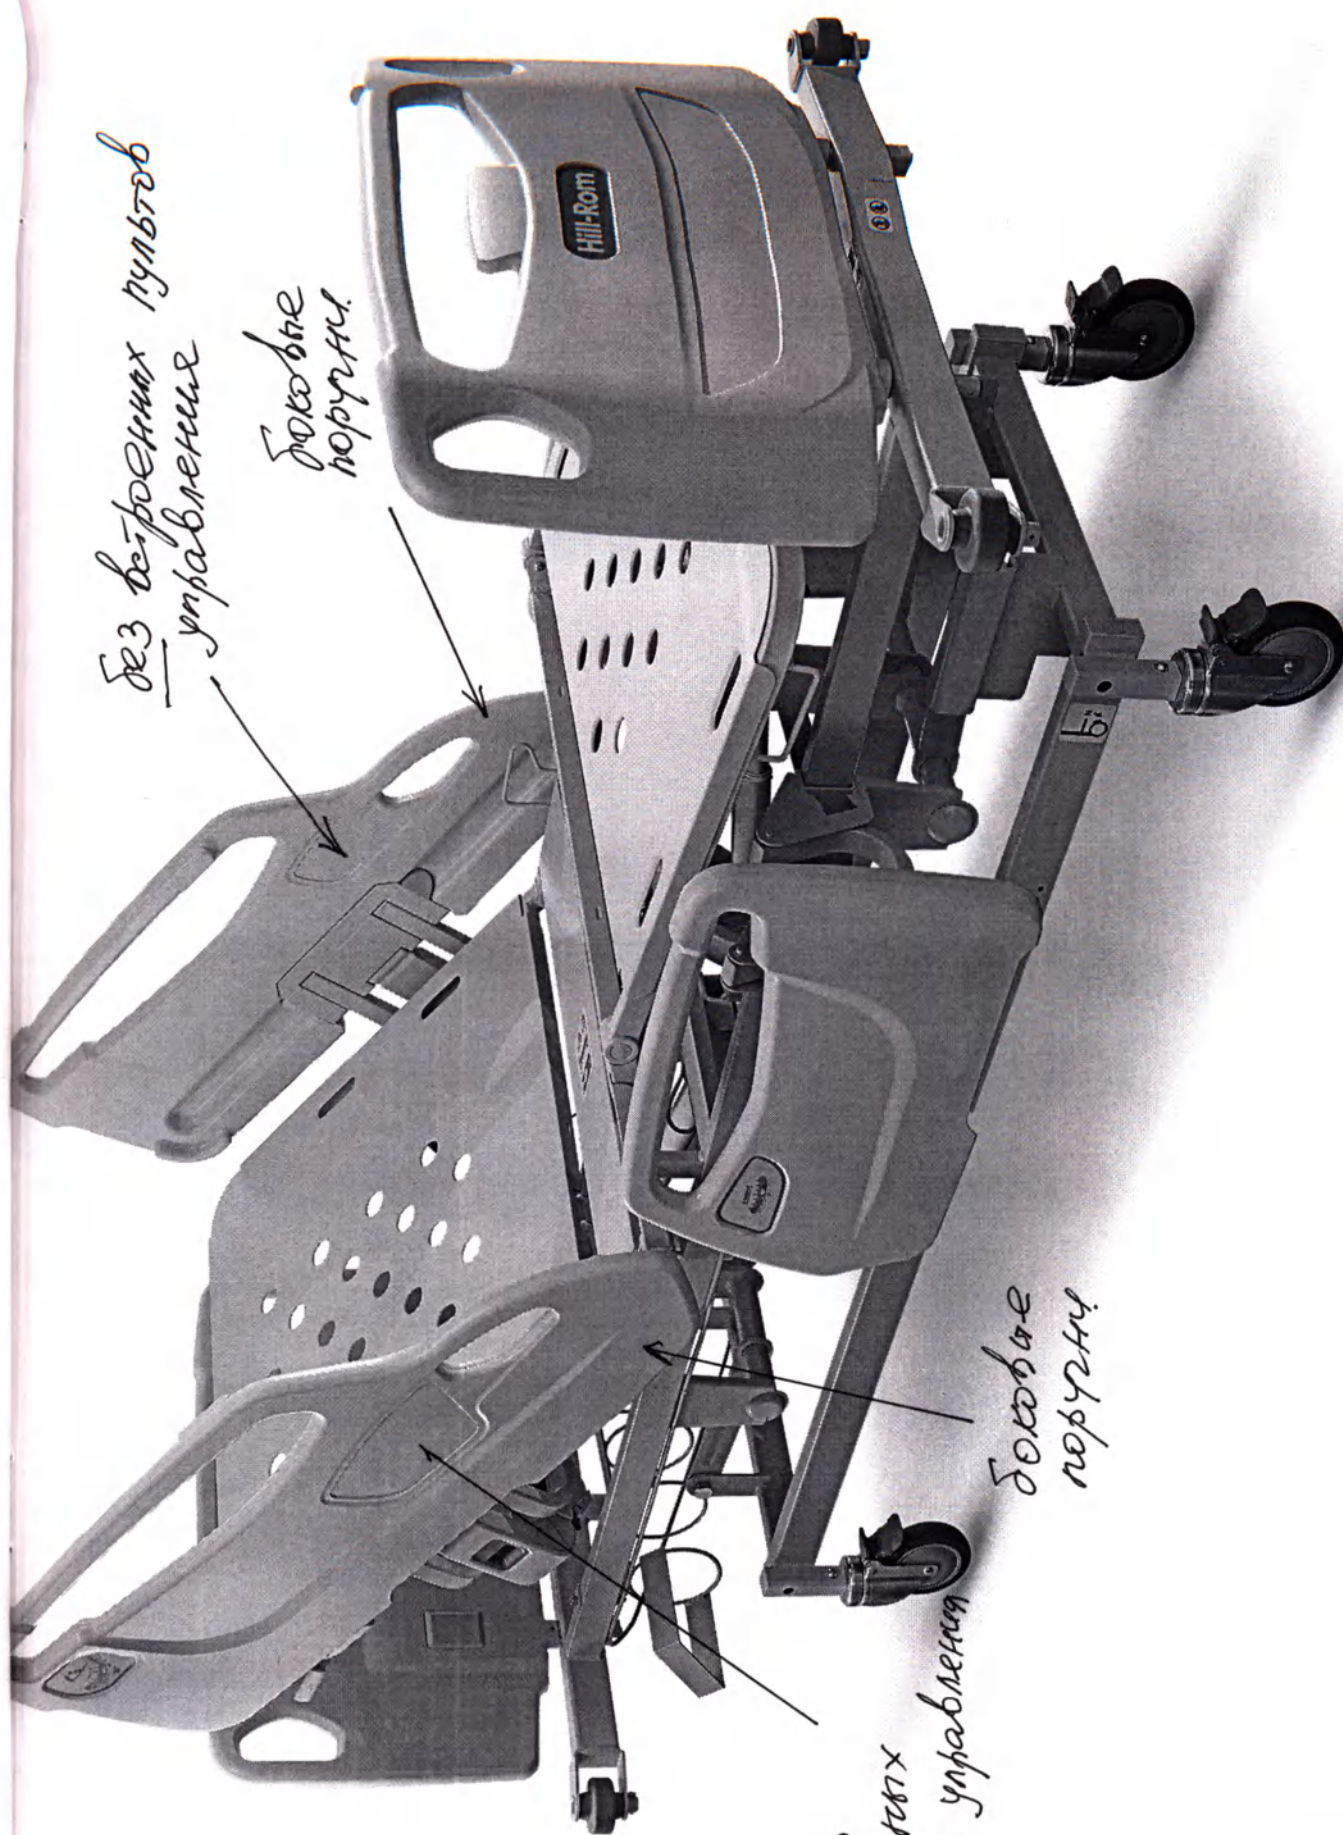

без
встроенных
пультов управления

боковые
поручни

без встроенных
пультов
управления

боковые
поручни

2. Раздельные боковые поручни без встроенных пультов управления
- пара.



3. Головная стенка

Hill-Rom


4. Ноющая спина.




← 5. Упругий амортизатор - кит.
(по оси с каждой стороны кровати)



1) измеритель
4 измерителя постоянного тока

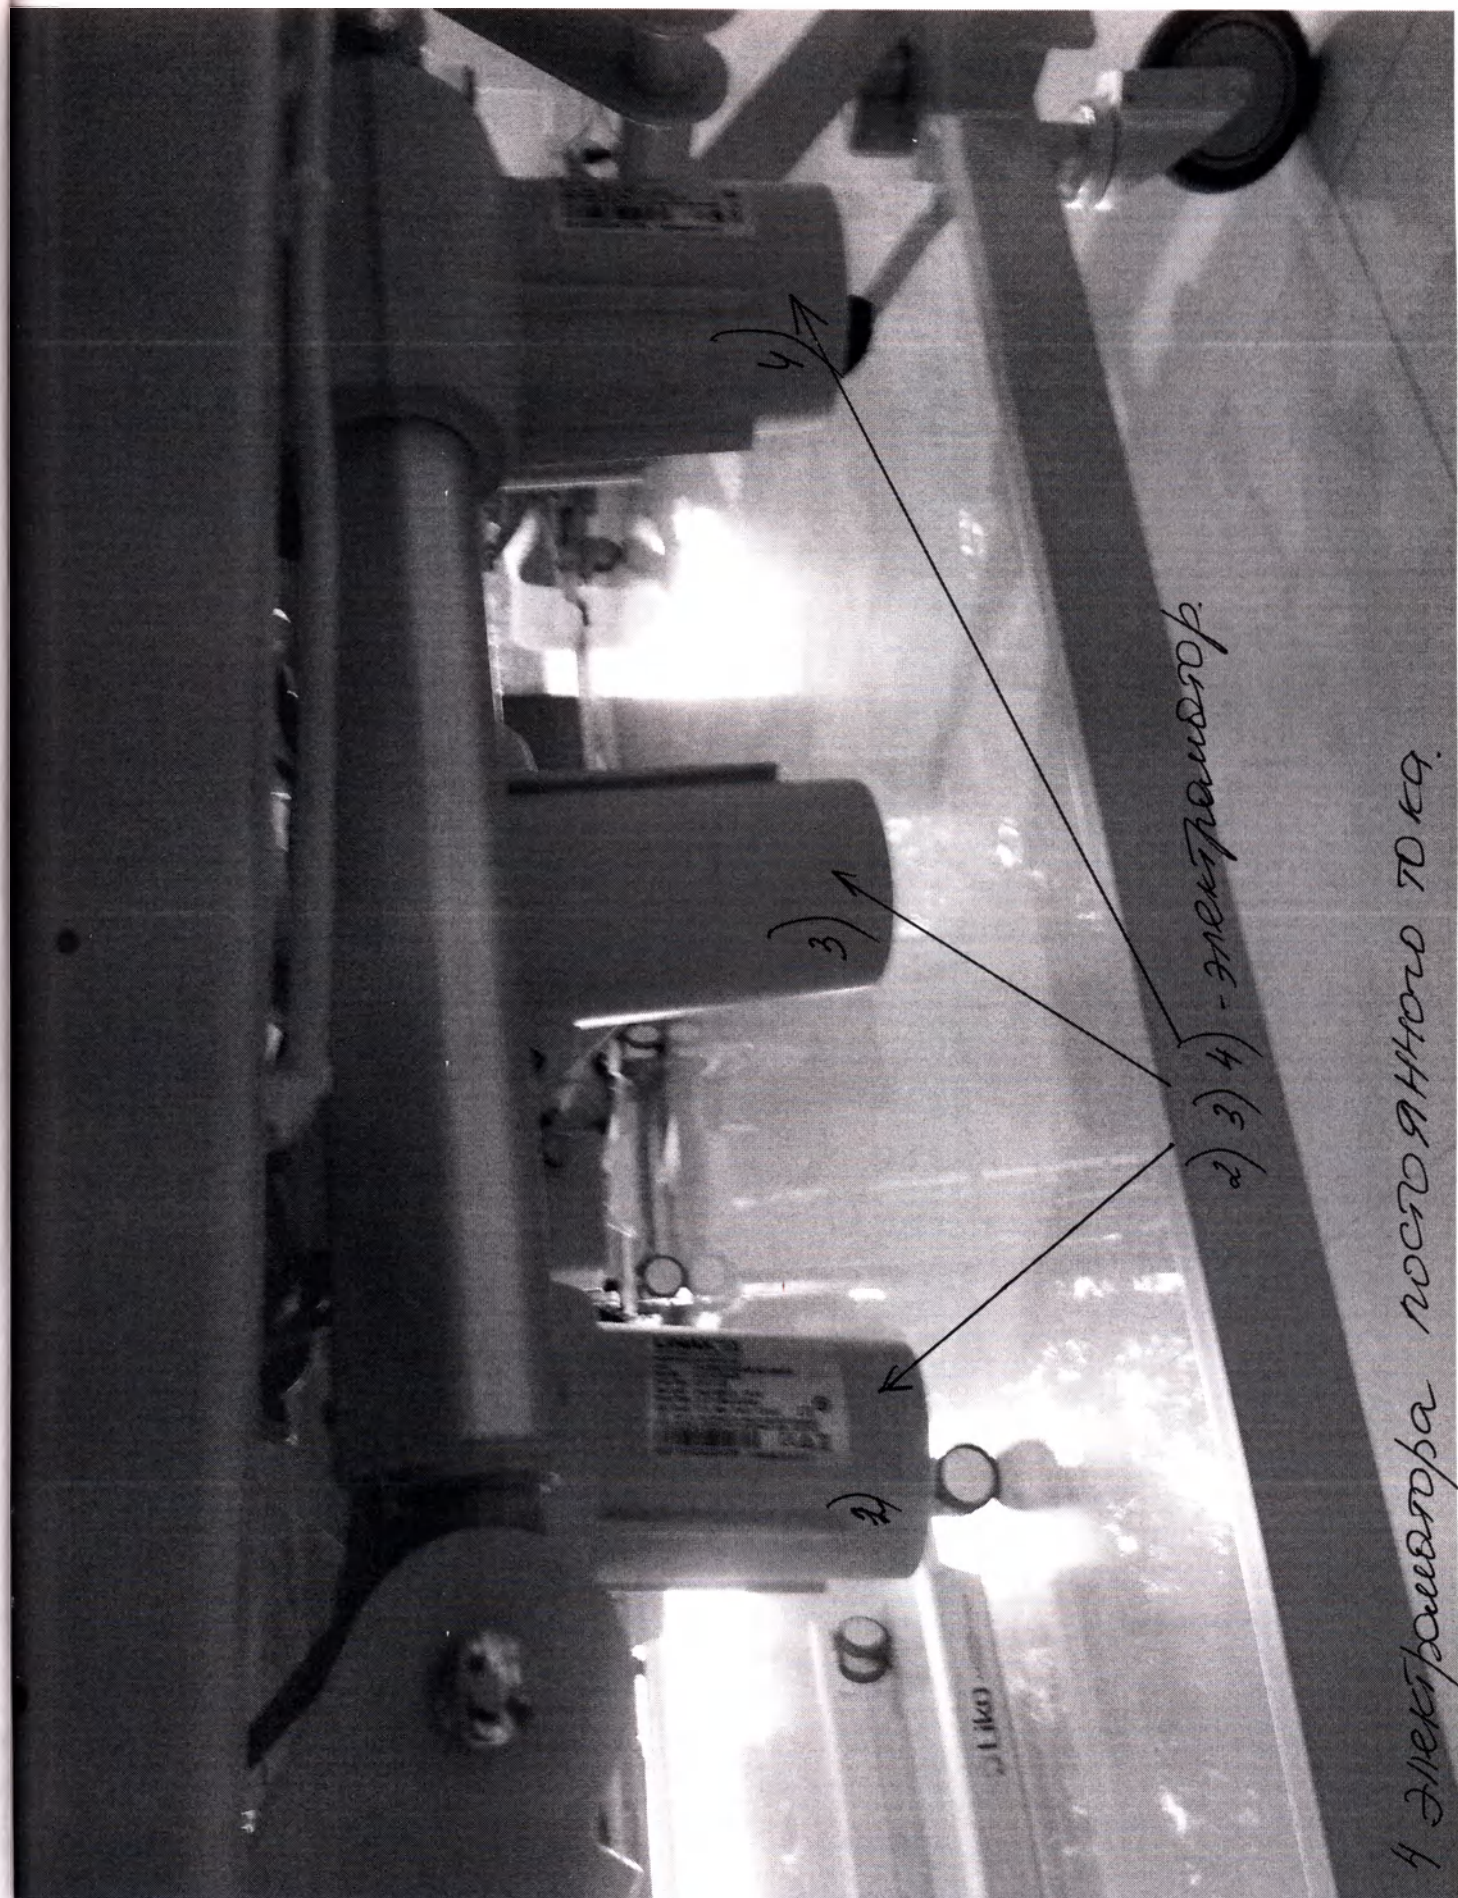

6.

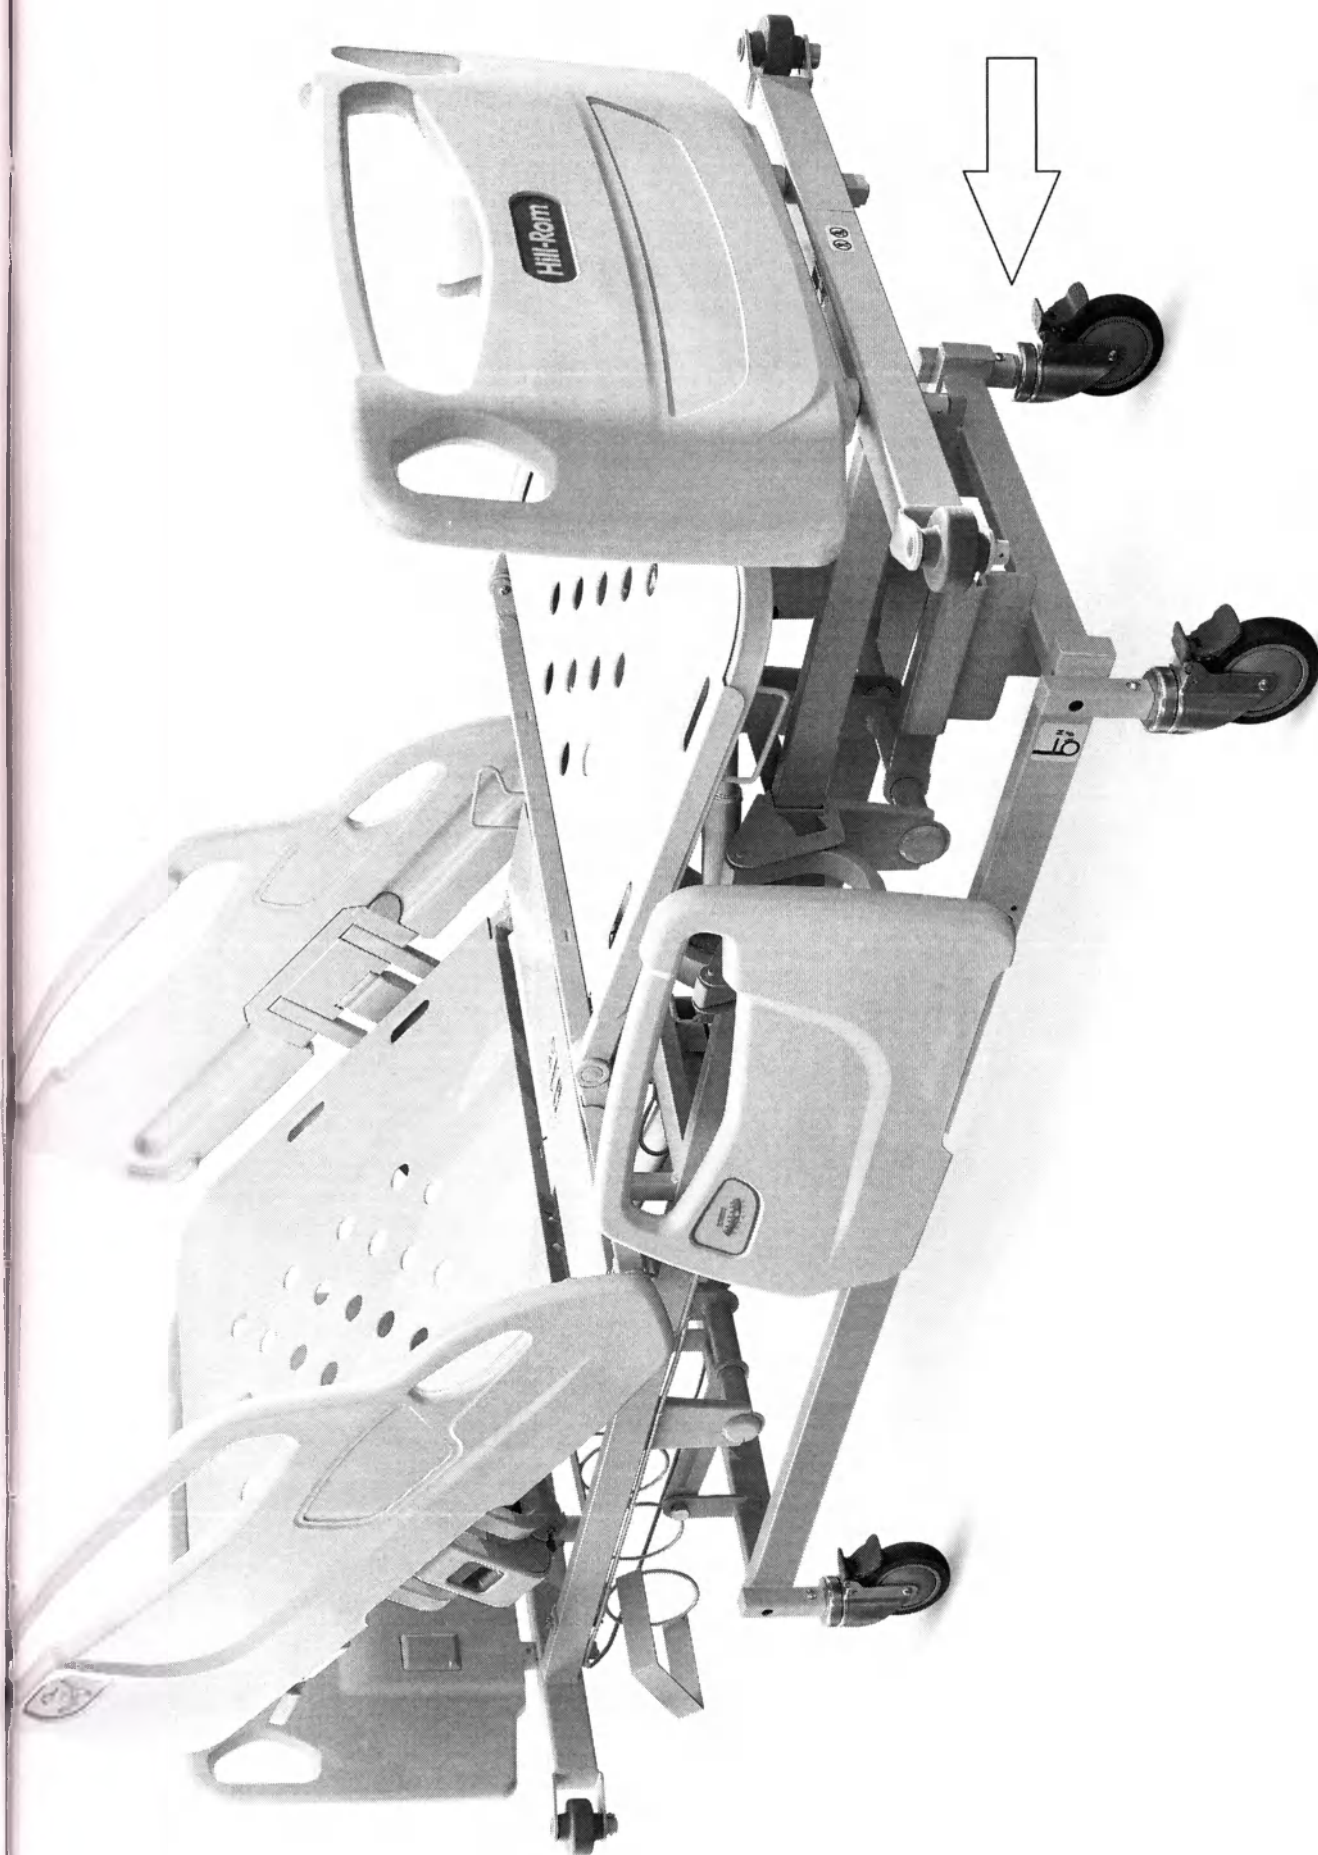


7. Педаль тормоза или переключателя тормоза/управления в нижней секции.




Порвешной пульт управления



Ручка перебора в положении для СЛР - 2 шт

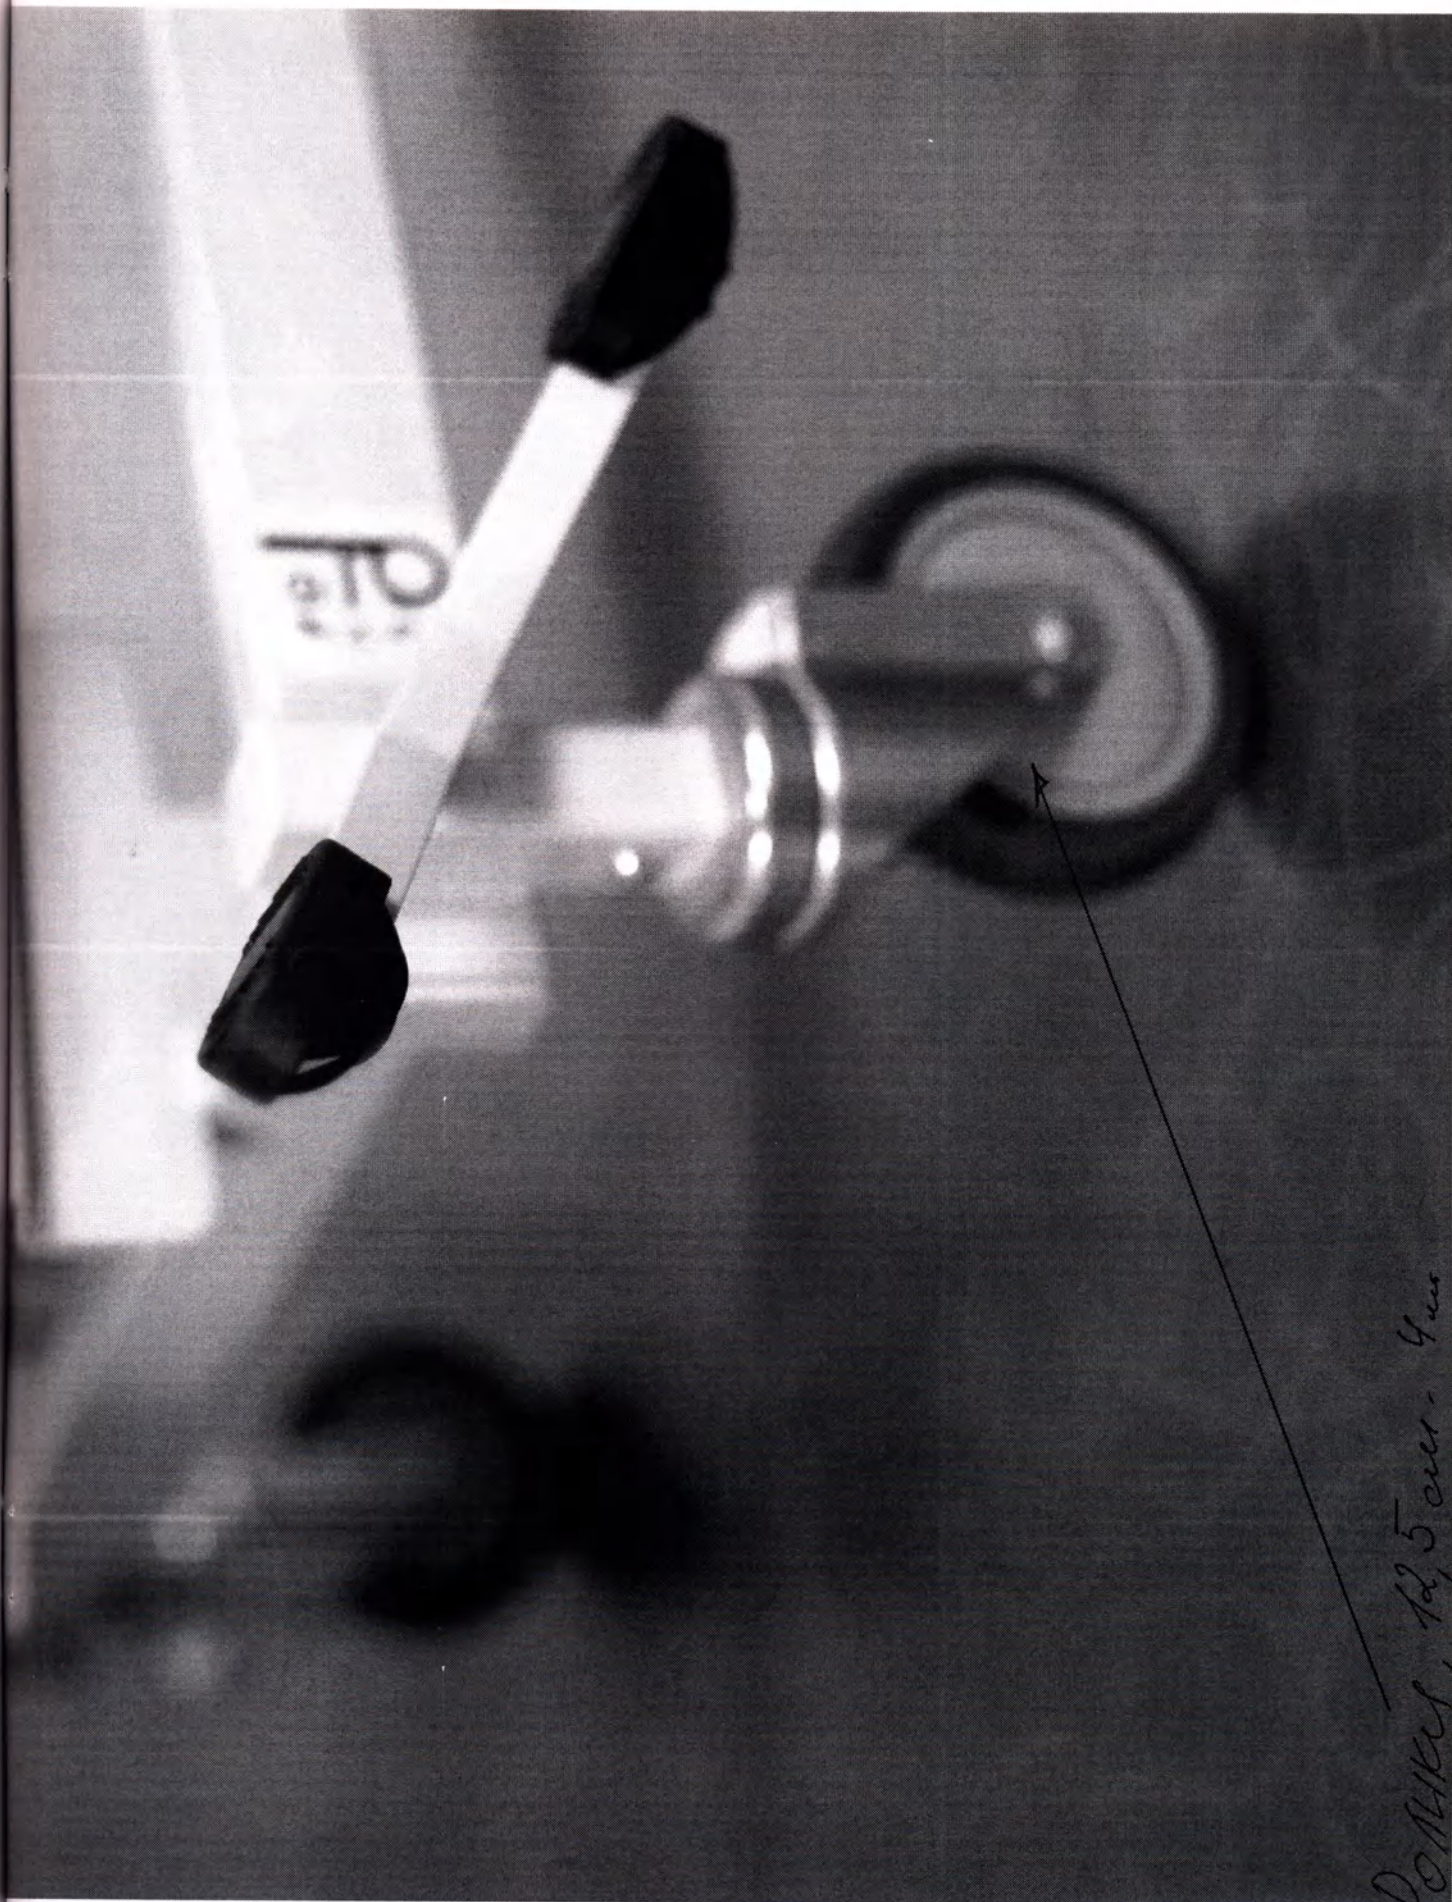

10. Проверка, 12,5 мм - 4 мм

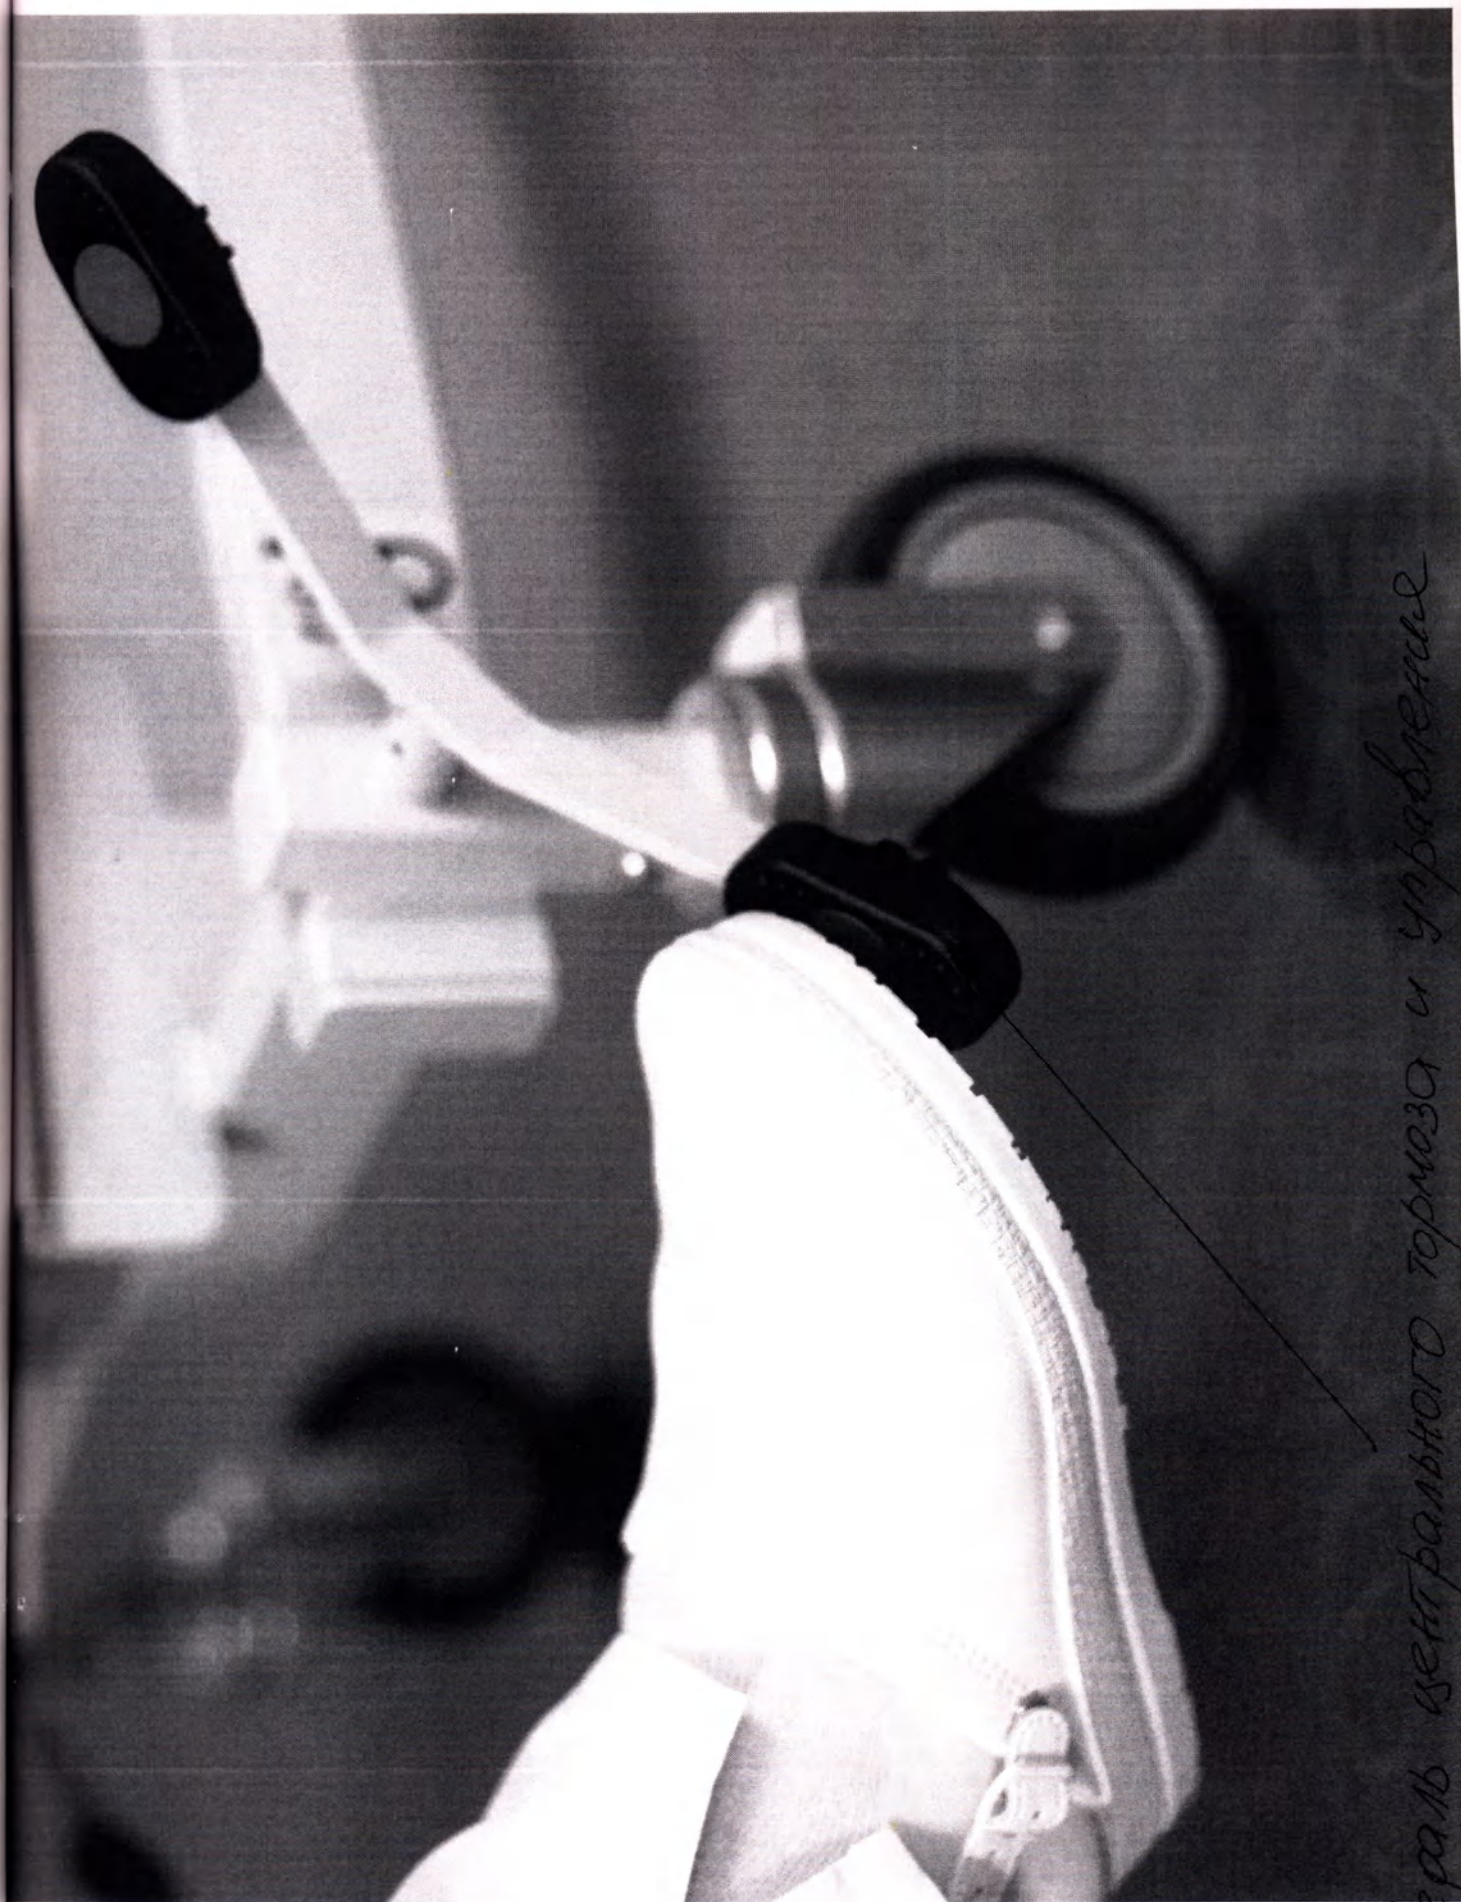

11. Перья центрального тормоза и управление




Матрица памяти прожекторный Hill Rom NP50 (AS5028) 198cm x 90cm x 14cm



13. Матрас противопалаточный Hill-Rom NP50 (NP50A7F) 203,2 см x 90,2 см x 15,2 см



14. Матрас противопролежневый Hill Rom M2400/ASS 031) 198 см x 90 см x 11 см

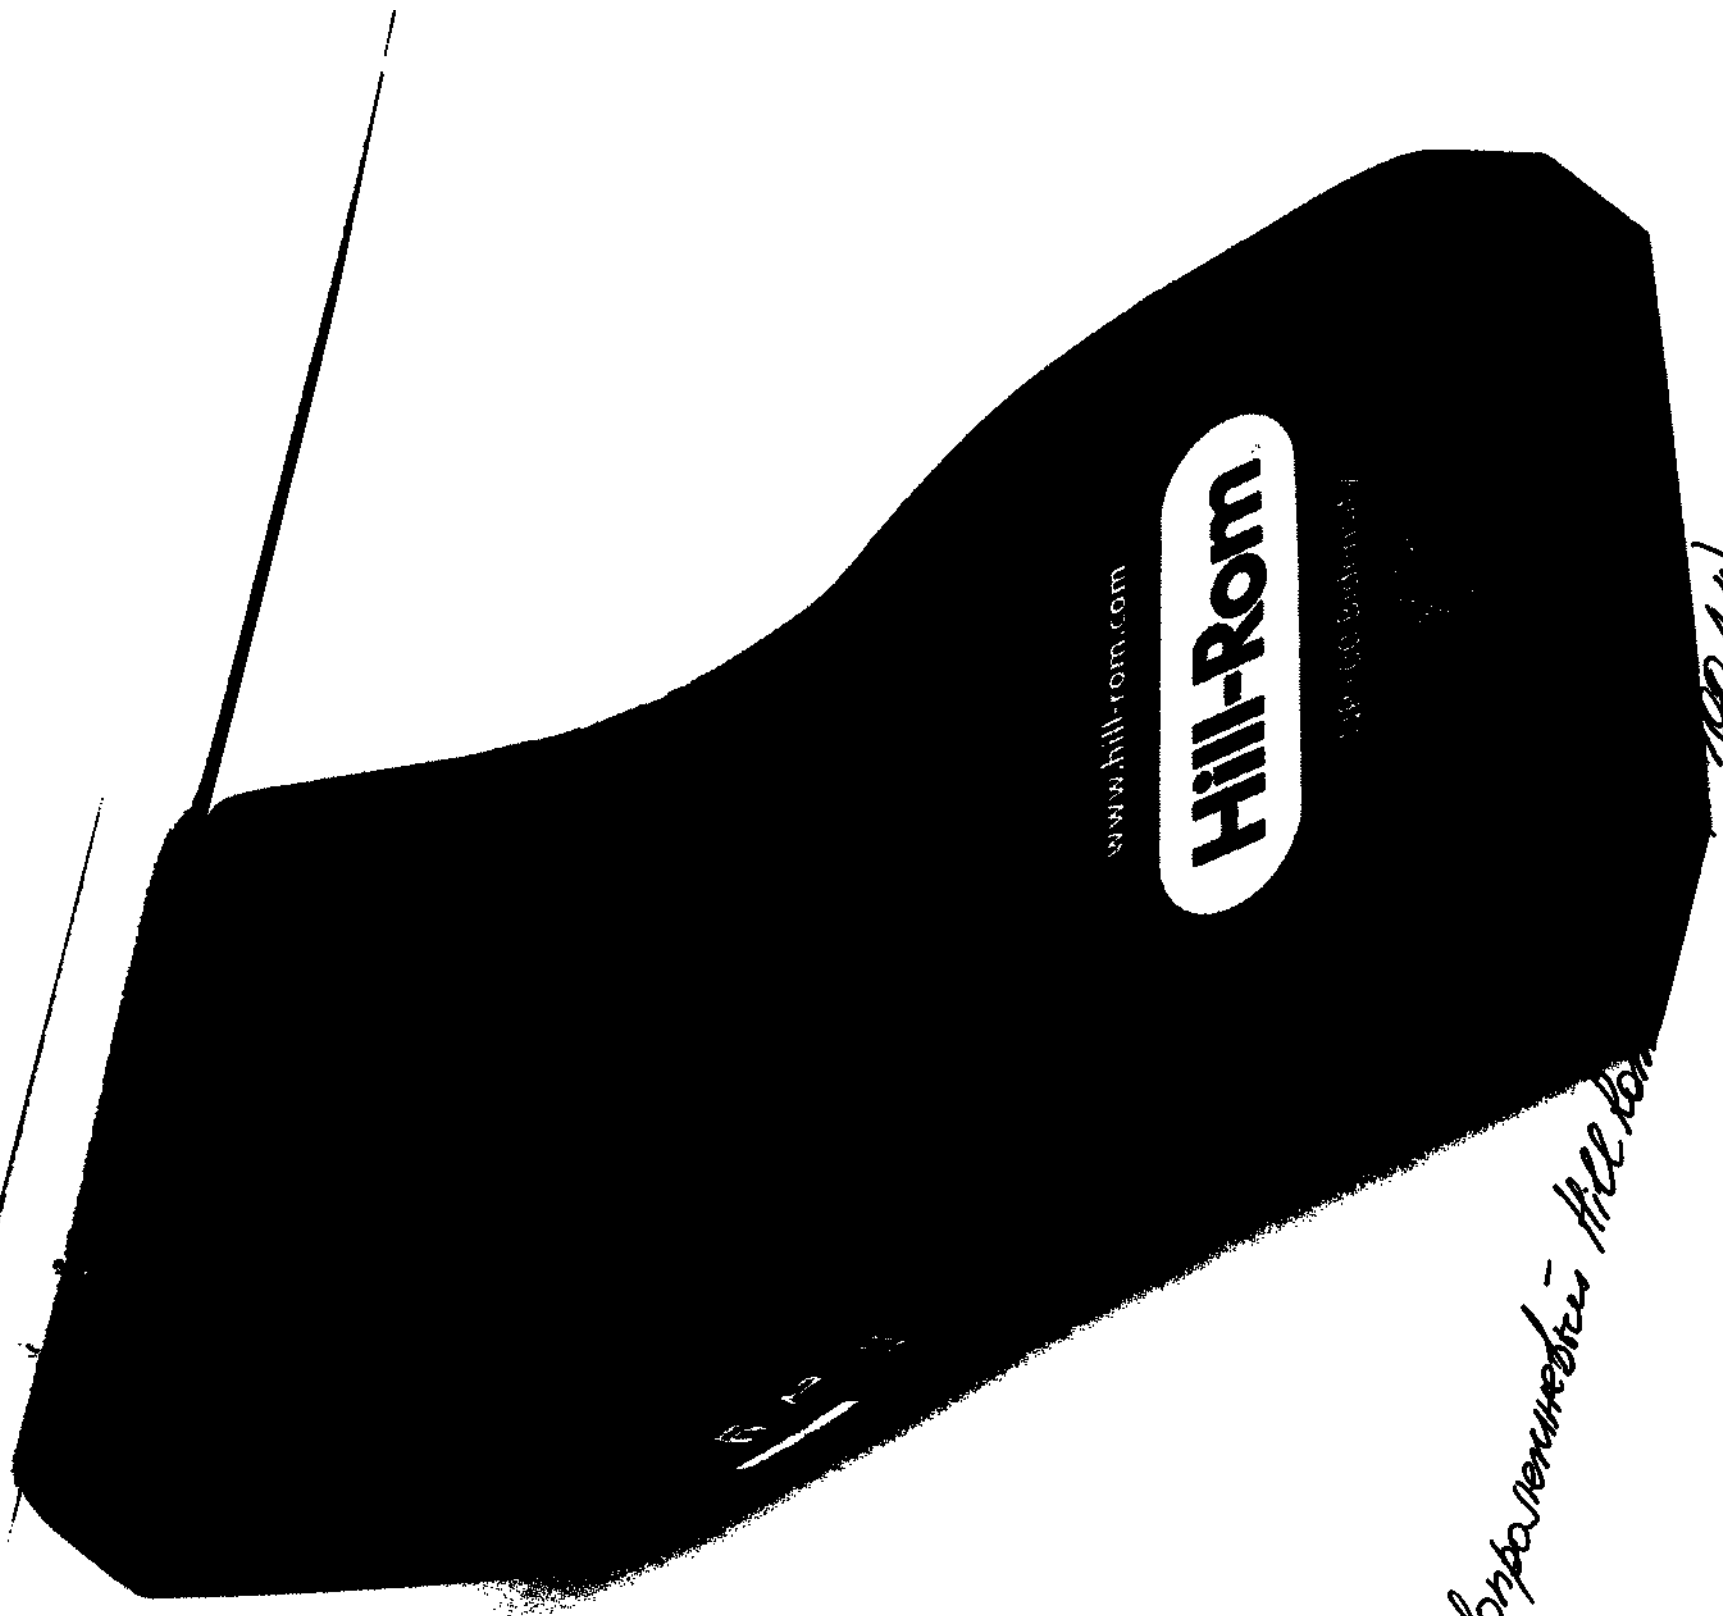

15. Машина медицинская - Hill Rom

100-44) 203,2cm x 90,2cm x 15,2cm



16. Матрас противопавильный Hill Rom NP130/ASS034) 198cm x 90cm x 14cm



ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU *Бон-полемне-воту P564CA3 Basic, Nylon Ticking 203,2cm x 90,2cm x 15,2cm*
 17. *Шарпан*




18. Машина: протуберанснер- D709CB1 Shearless, 203cm x 90,2cm x 15,2cm




19. Самая интуитивная стойка




0 Съемная функциональная стойка (выносная)

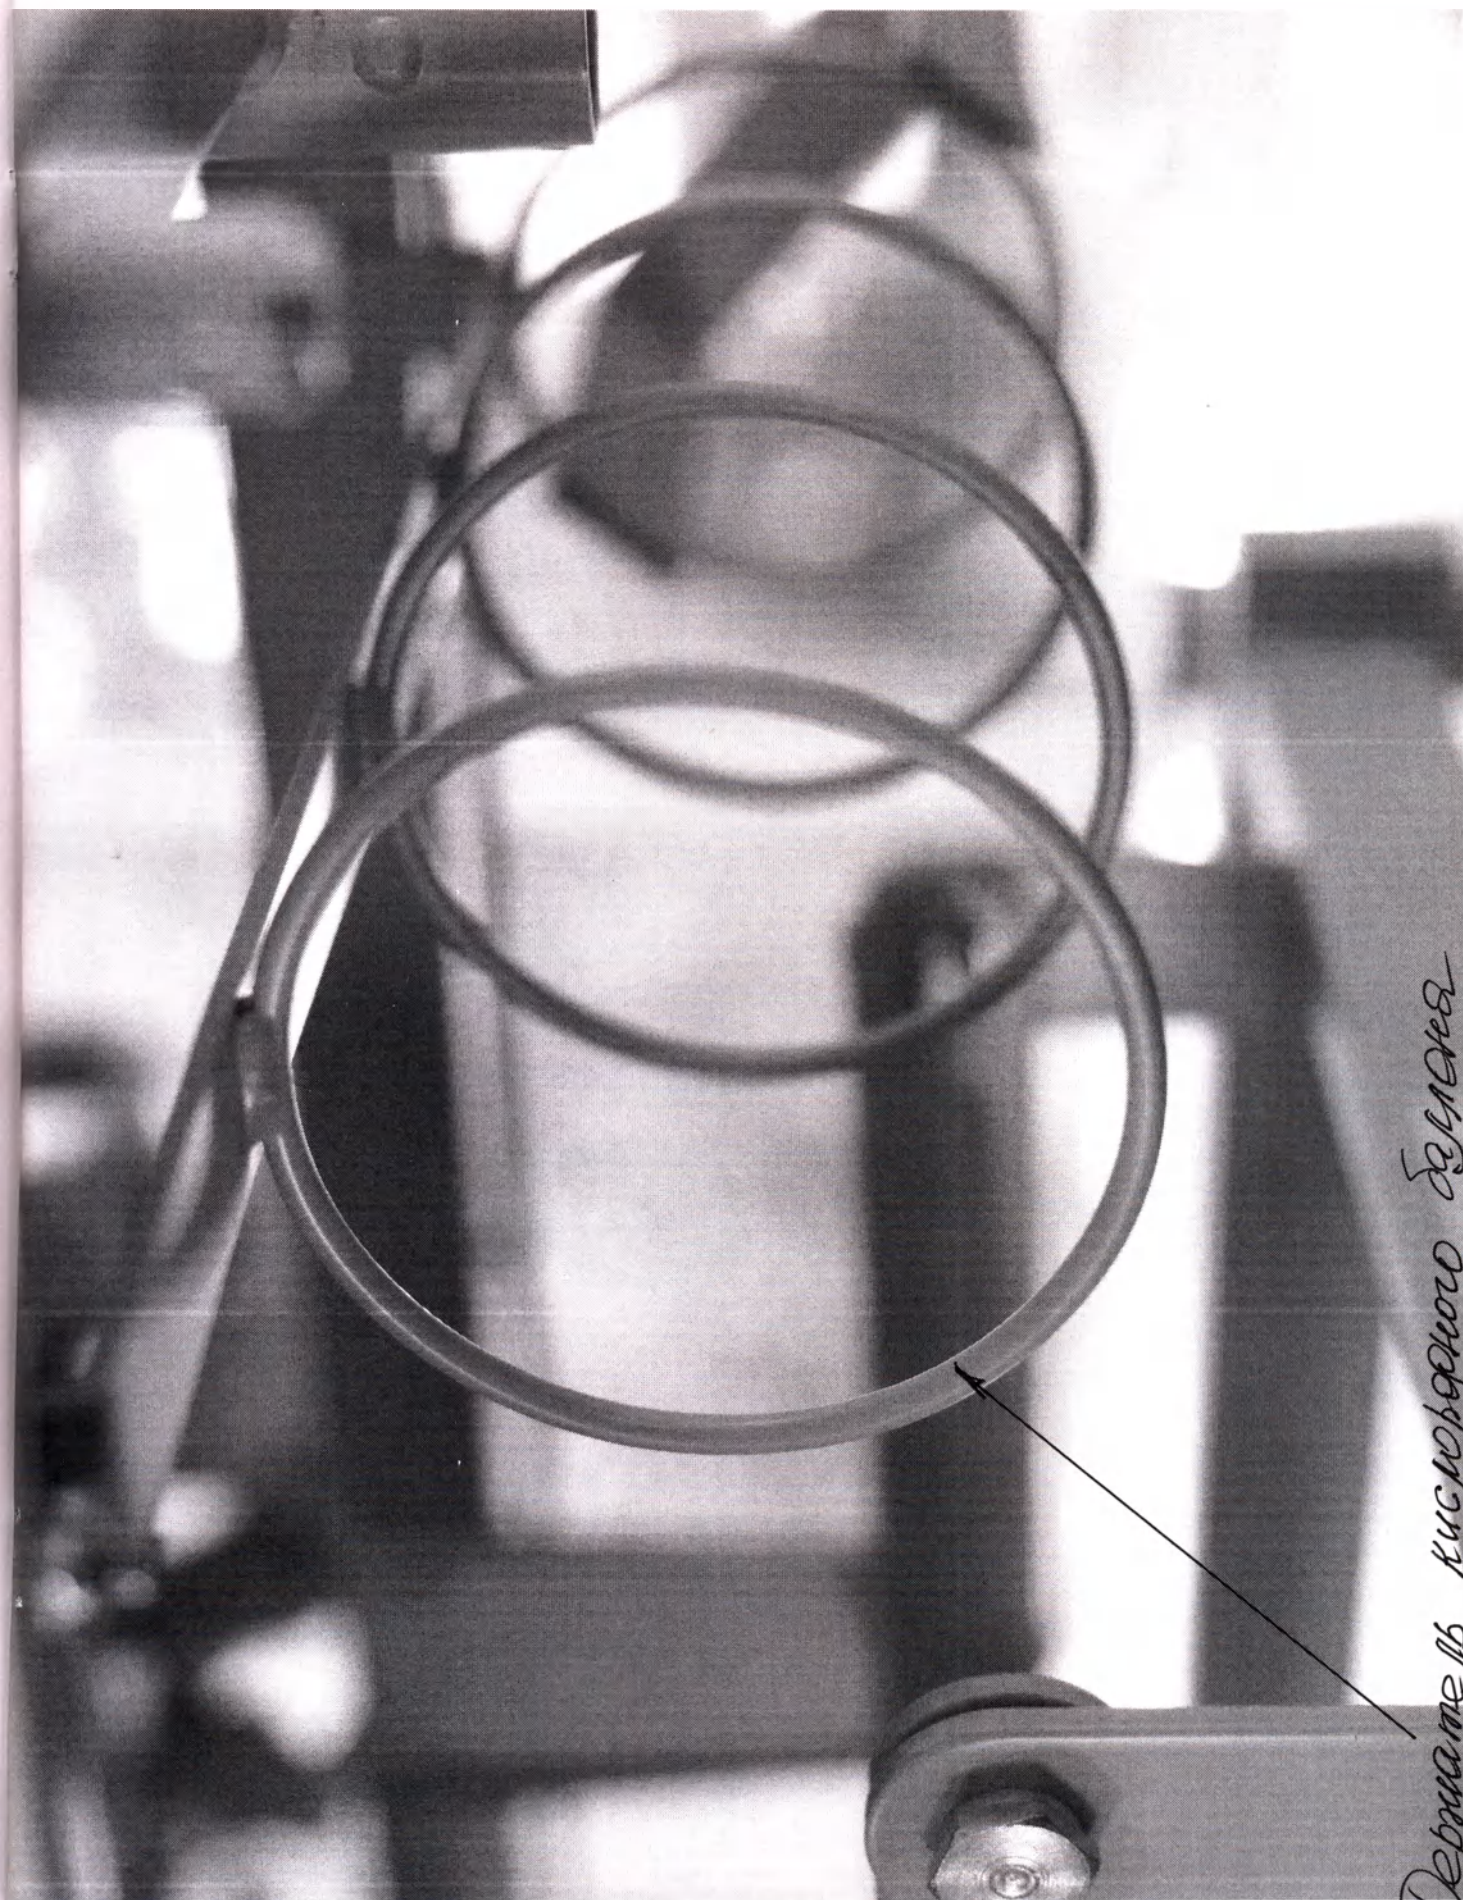

21. Держатель кислорода баллона

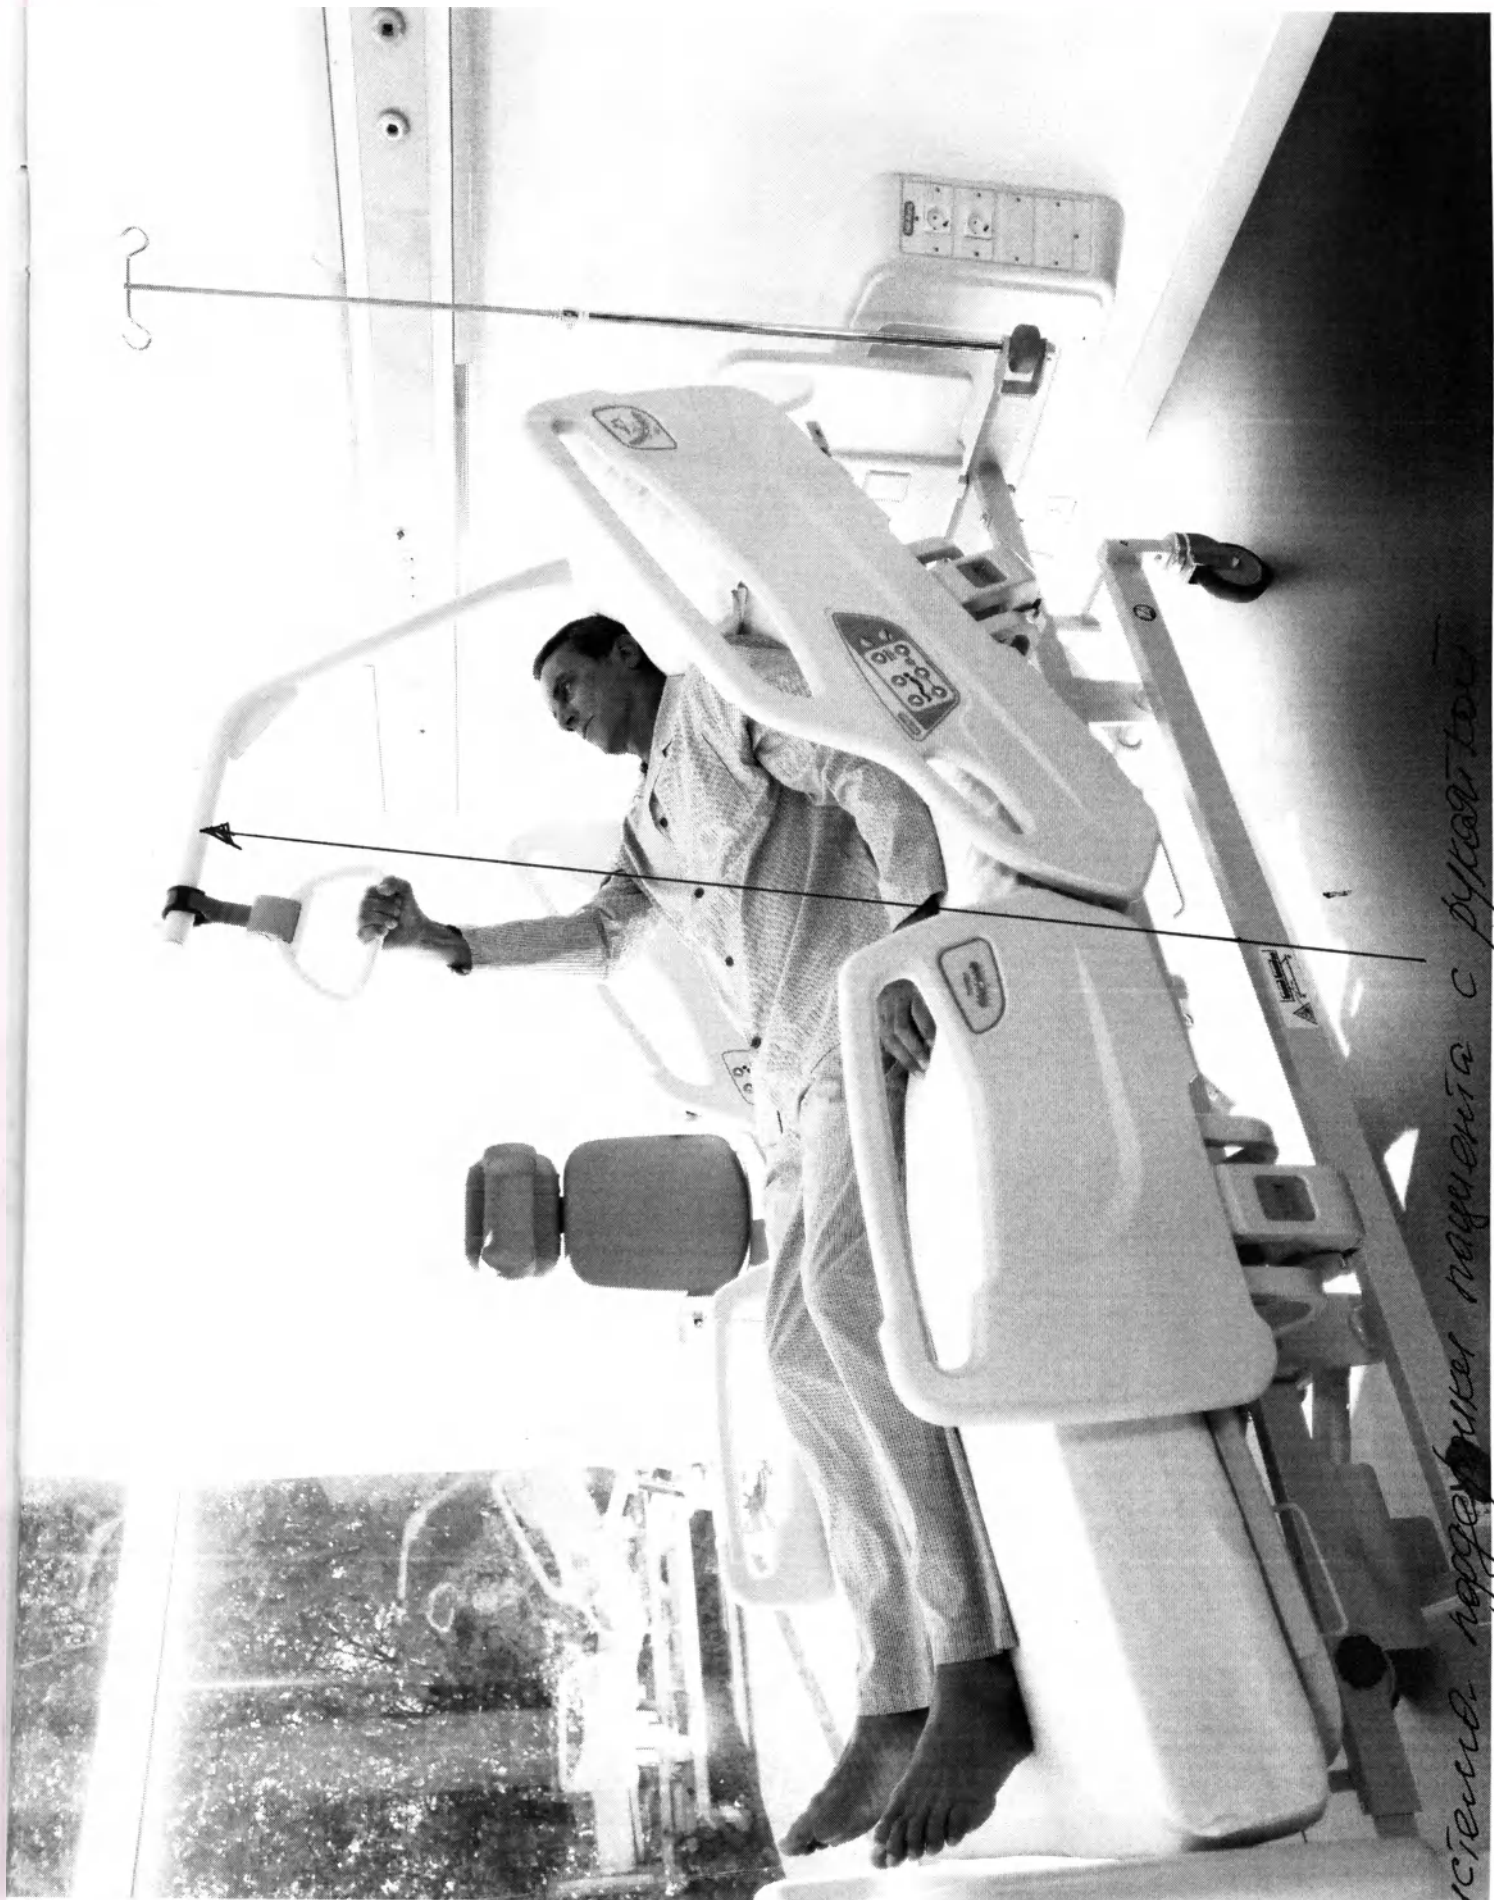


22. Система поддержки пациента с ручным приводом

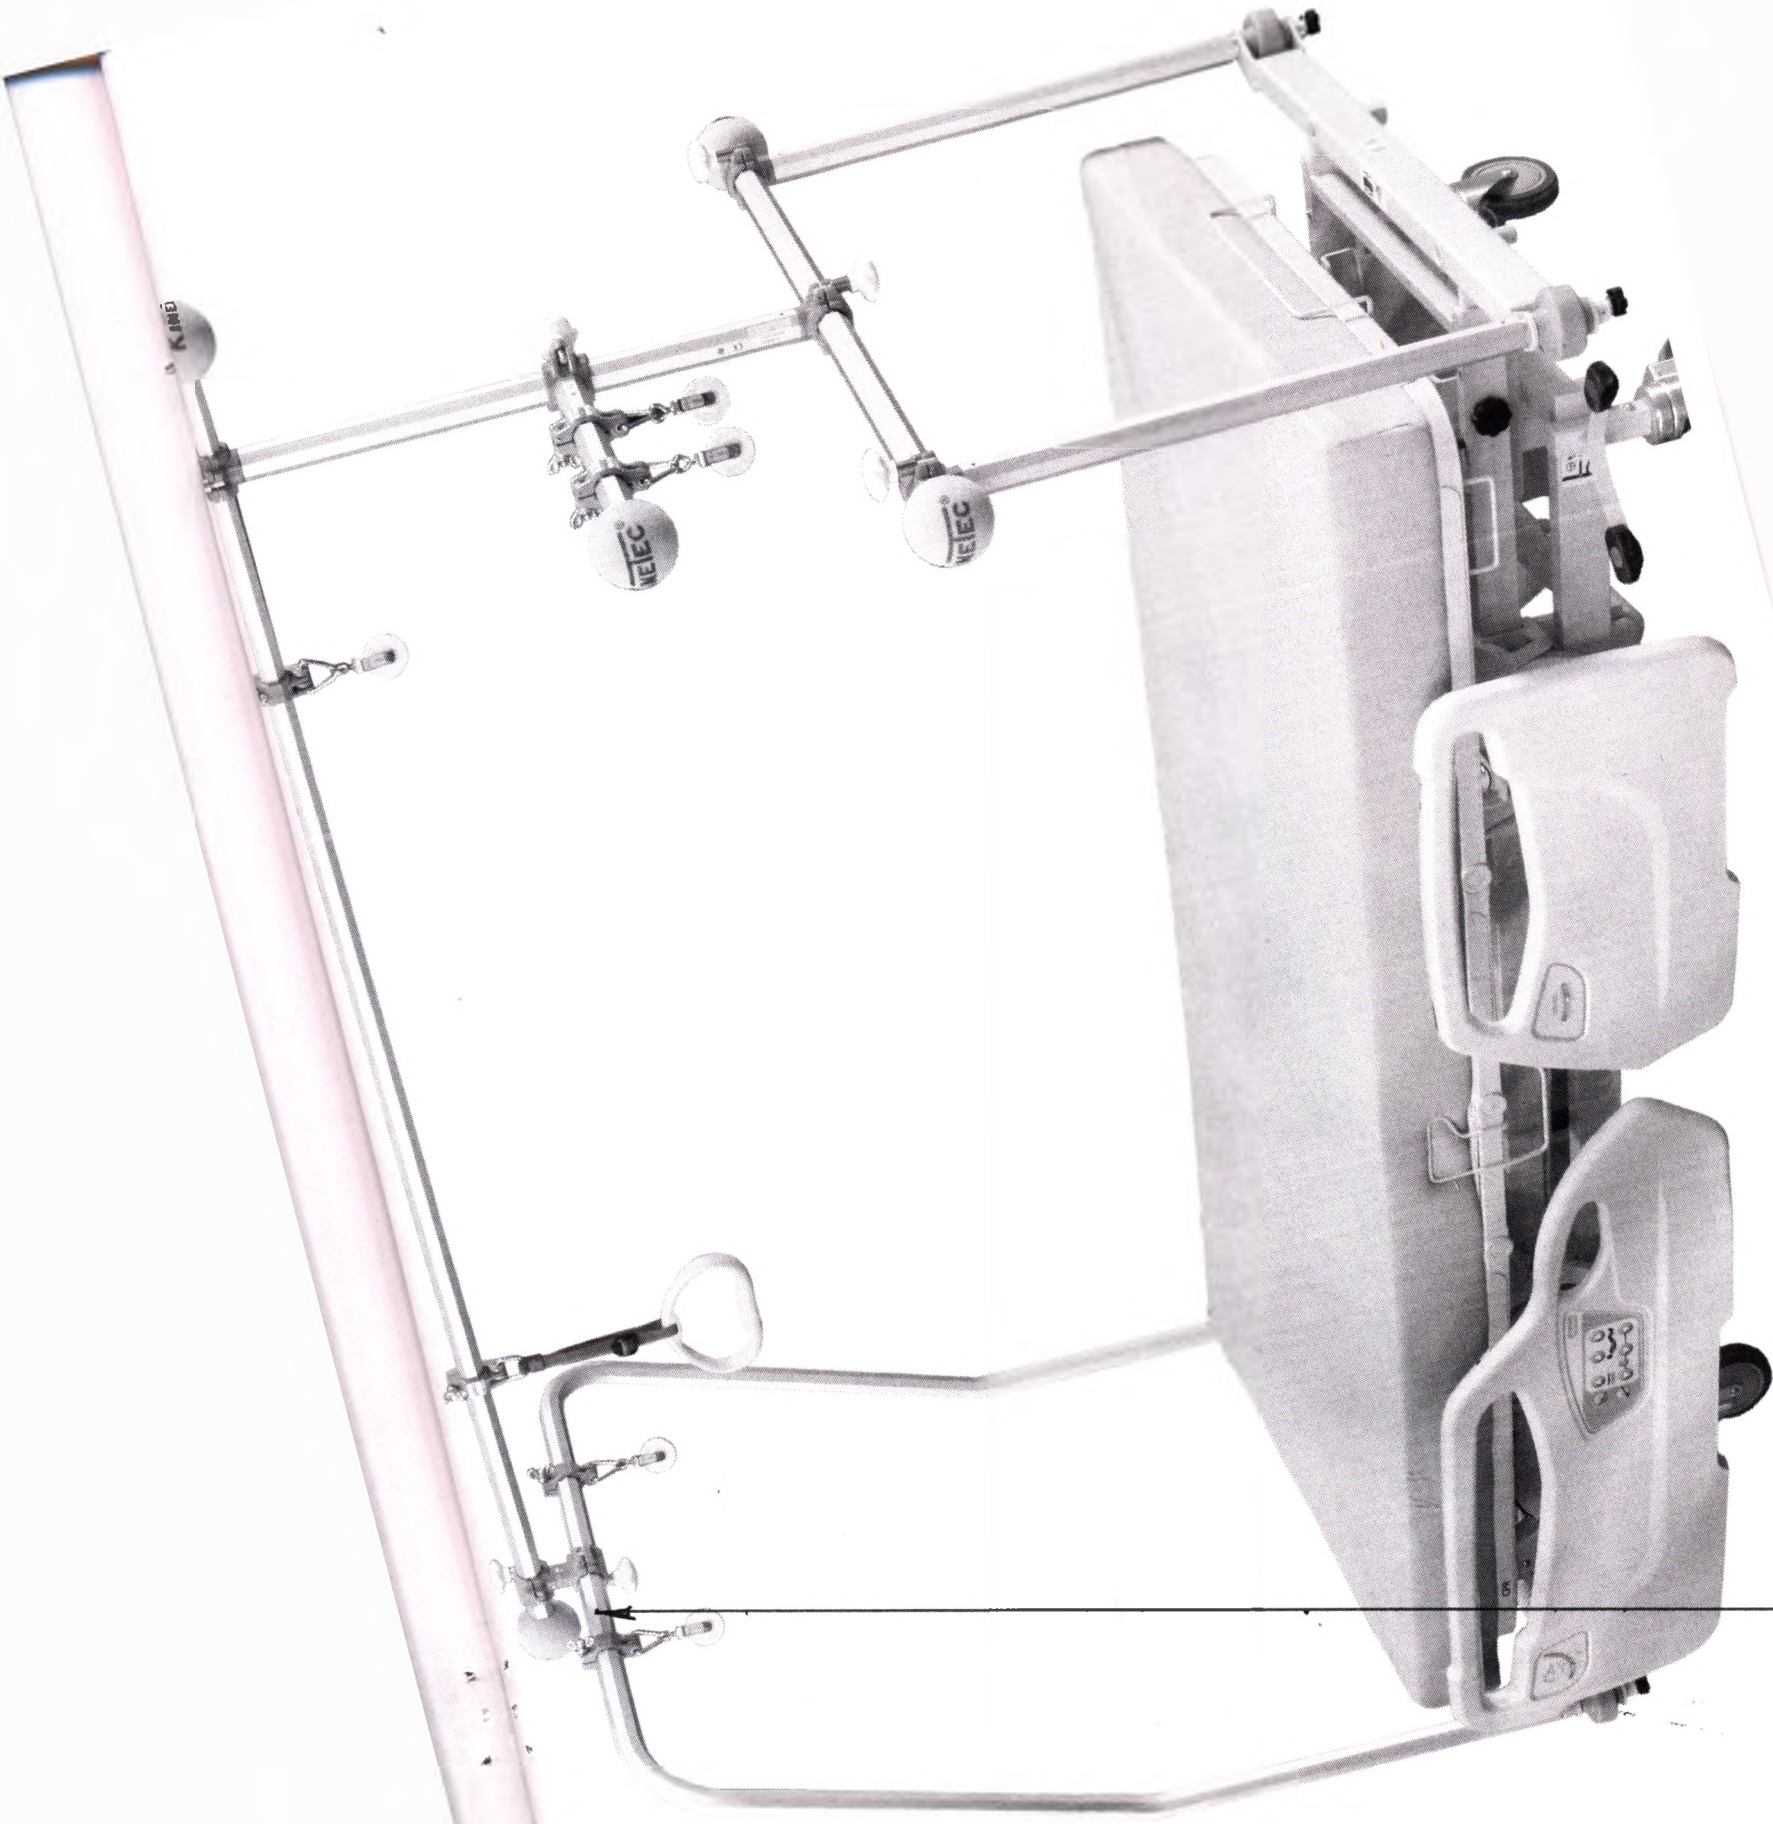

д.3. Таблица показателей.



24. Уменьшить матрас

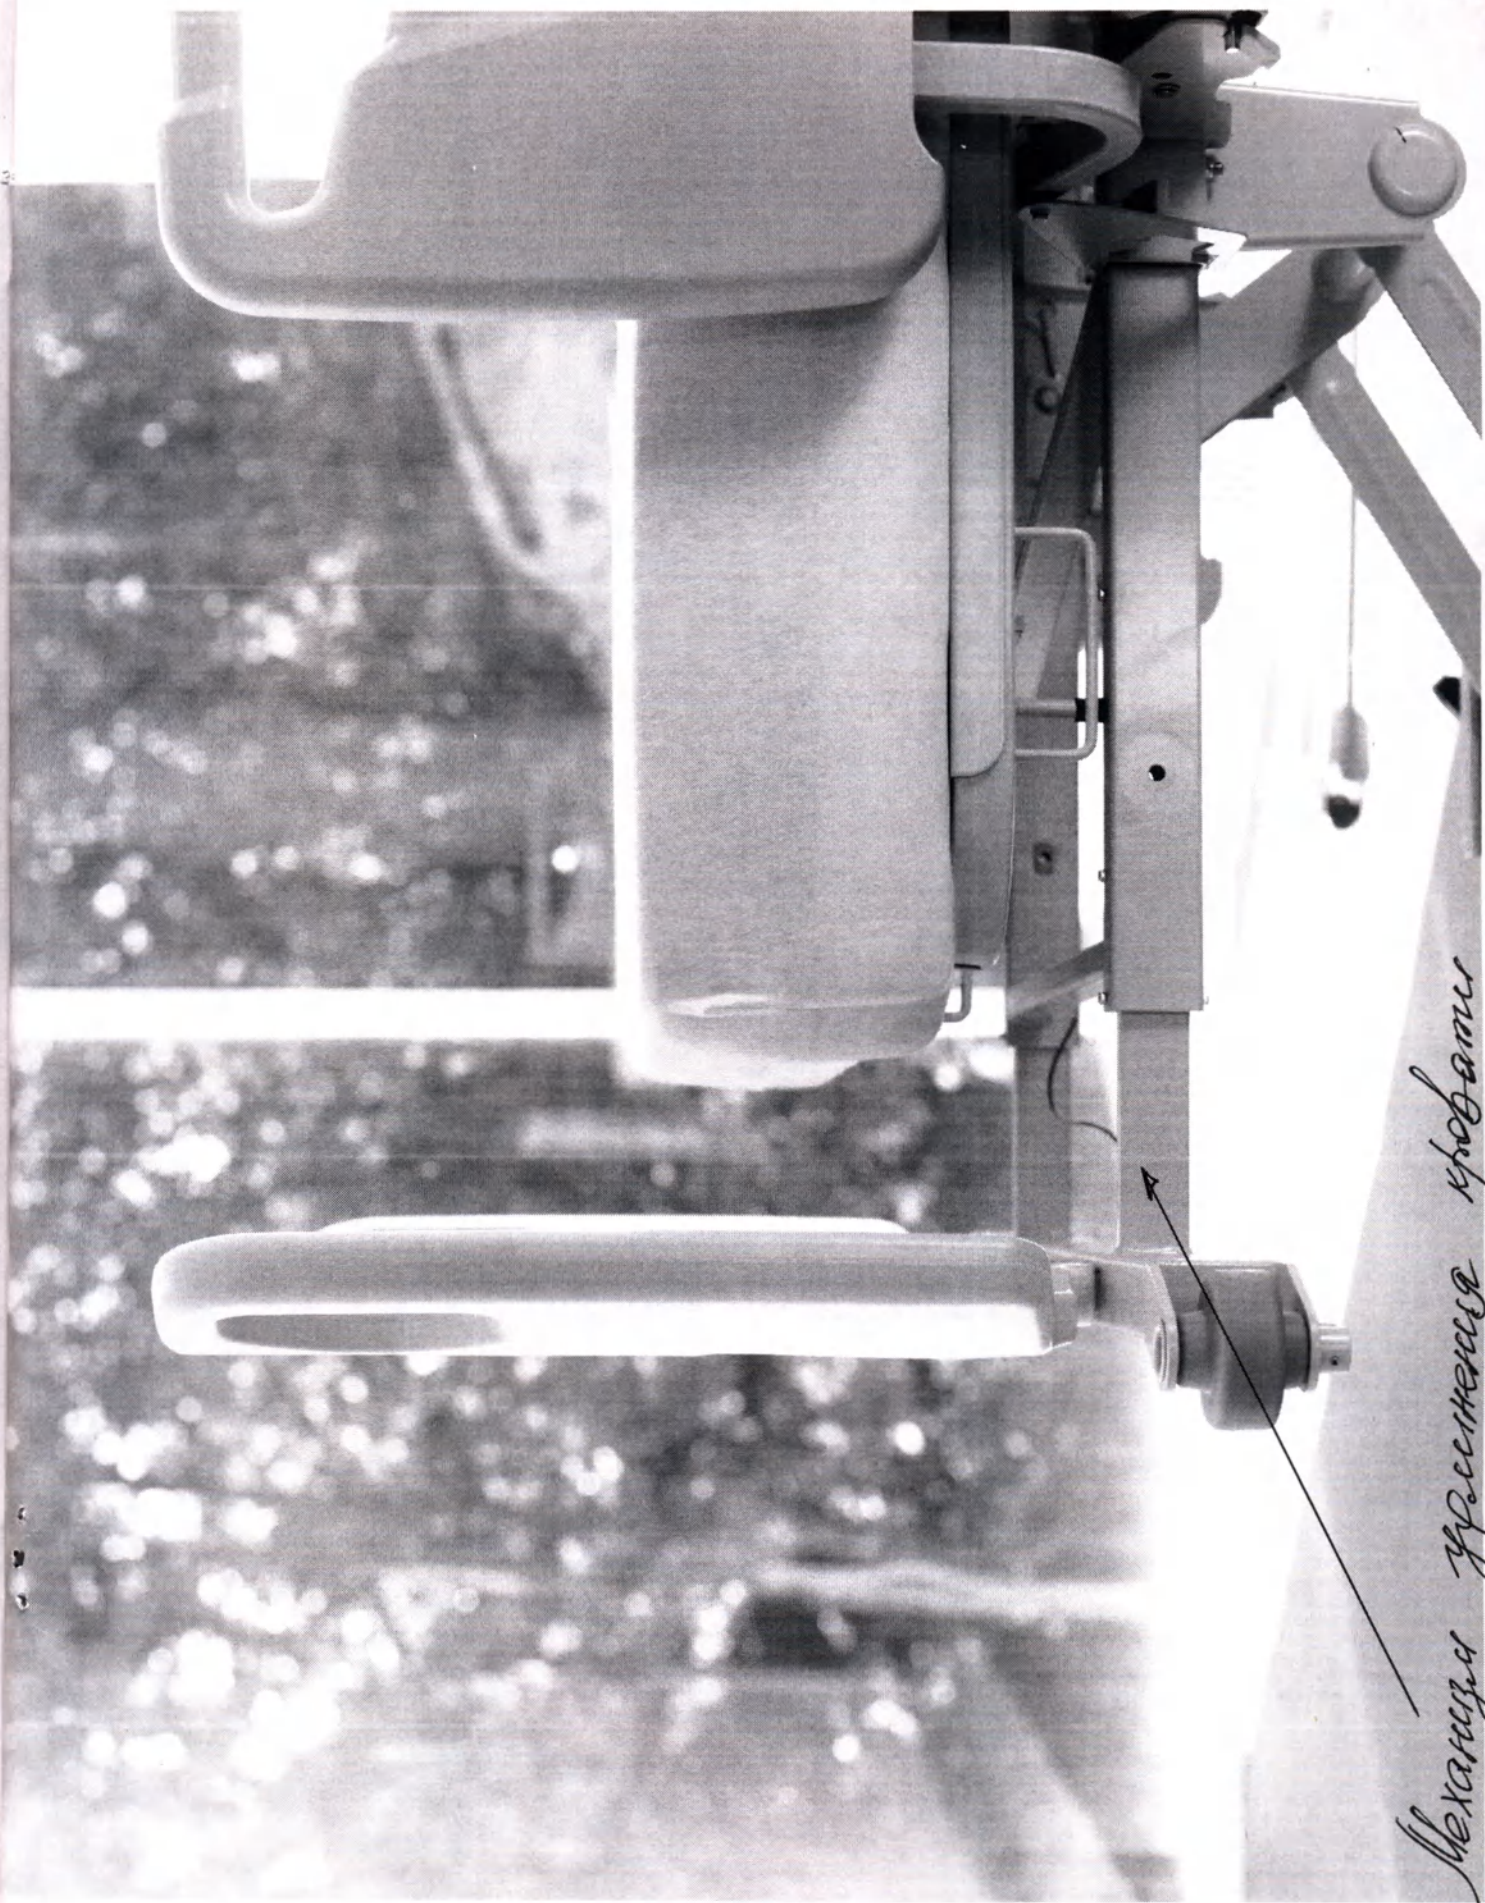

25. Механизм фиксации положения

Прошито и скреплено
печатью ООО «Хилл-Ром

Генеральный директор
ООО «Хилл-Ром Рус»



-27-

2
1
1