

Фотографические изображения медицинского изделия

Система реанимационная открытая для новорожденных BQ 80

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Медстратегия»



Кизилова А.М.

(подпись и печать)

Система реанимационная открытая для новорожденных BQ 80 (вид спереди)




Система реанимационная открытая для новорожденных BQ 80 (вид сбоку)



SN 


B2231128007



28.11.2023

COMEN

IPX0



Система реанимационная открытая для новорожденных BQ 80

Номинальное входное напряжение: 220-240В~

Номинальная частота: 50/60 Гц

Номинальная входная мощность: 5.0-5.1 А

Регистрационное удостоверение

№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXXг.

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of

Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,

Guangming District, Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.

БН С НОМ 39.49



Система реанимационная открытая для новорожденных BQ 80

COMEN

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXXг.

Размер упаковки: 1198 мм (длина) x 708 мм (глубина) x 2049 мм (высота)

Масса нетто: 115 кг Масса брутто: 185 кг Количество в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)




Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.

ИН С НОМ 39.49

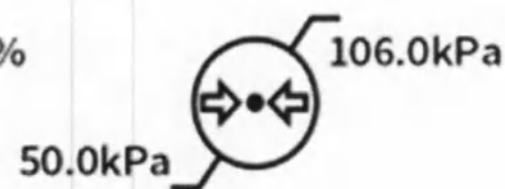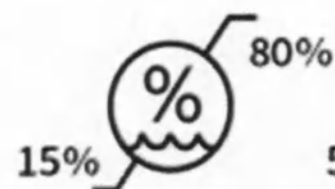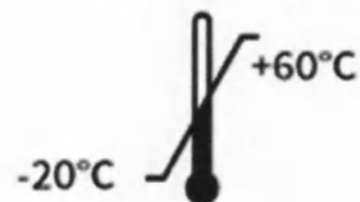

Система реанимационная открытая для новорожденных BQ 80

Габаритные размеры: 1198 (Длина) x 708 (Ширина) x 2049 мм (Высота)

Масса (нетто): 115 кг Масса (брутто): 185 кг Количество изделий в упаковке: 1 шт.

Комплектность:

Основной блок BQ 80 – 1 шт;
 Кабель питания (040-000293) – 1 шт;
 Кабель заземления (040-000008) - 1 шт;
 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
 Датчик температуры, модель CMAT3101- 1 шт;
 Матрас 693×563мм (040-001071) – 1 шт;
 Бумага для печати (040-000116) – 1 шт;
 Модуль C31 (0038-CPZ) – 1 шт;
 Модуль взвешивания встраиваемый (115-006303-00) – 1 шт;
 Кабель-удлинитель для ЭКГ на 3 отведения для новорожденных, модель 98ME01EB046 – 1 шт;
 Кабель для ЭКГ на 3 отведения для новорожденных, модель 98ME01AC658 – 1 шт;
 Электроды MSB для младенцев/новорожденных, модель QGD-SF02-37×42 – 1 шт;
 Кабель датчика SpO2, «Масимо», модель SLZ133 - 1 шт;
 Многоцветный датчик SpO2 для взрослых/детей/новорожденных, «Масимо», модель RD SET YI - 1 шт;
 Ремешок-крепление датчика SpO2 (049-000256) - 2 шт;
 Трубка НИАД 2м для взрослых/детей/новорожденных (040-000808) - 1 шт;
 Матрас 697×567мм (040-001078) - 1 шт;
 Прямой соединитель, модель G-311063-1- 1 шт;
 Сборка сильфонного соединения одноразовая, модель DVI200 - 1 шт;
 Вибратор для пробуждения при апноэ для новорожденных, модель A0916-C05 - 1 шт;
 Набор аксессуаров для увлажнения (115-00004230) - 1 шт;
 - Бутылка увлажнителя - 1 шт;
 - Держатель для бутылки увлажнителя - 1 шт;
 - Одноразовая соединительная трубка - 1 шт;
 - Одноразовая назальная канюля для кислородной терапии - 1 шт;
 Шланг для кислородного газа (040-000848) - 1 шт;
 Шланг для воздуха и газа (040-000849) - 1 шт;
 Одноразовый набор аксессуаров для отсоса (115-00004223) - 1 шт;
 - Держатель бутылки - 1 шт;
 - Бутылка для сбора жидкости, 2000 мл - 1 шт;
 - Соединительная трубка с фильтром - 1 шт;
 - Одноразовый мешок для сбора жидкости - 1 шт;
 Многоцветный набор аксессуаров для отсоса (115-00004409) - 1 шт;
 - Держатель бутылки, фиксированный - 1 шт;
 - Бутылка для сбора жидкости 1000 мл - 1 шт;
 - Соединительная трубка с фильтром - 1 шт;
 Жажим для газового шланга (034-000006)- 2 шт;
 Адаптер-кислород (041-001815) - 1 шт;
 Адаптер-Воздух (041-001816) - 1 шт;
 Выходное гнездо ИБП (023-00000365)- 8 шт;
 Креплений газовых баллонов (115-00004221) - 1 шт;
 Корзина (115-00004222)- 1 шт;
 Трубка НИАД 3м для взрослых/детей/новорожденных, модель CMANOB01- 1 шт;
 Опорный рычаг дыхательного контура (115-00004539) - 1 шт;
 Модуль CO2 бокового потока, «Масимо», модель 4410 – 1 шт;
 Линия отбора проб CO2, модель PN:3828 – 1 шт;
 Кабель-удлинитель AG, модель 98ME07GC968 - 1 шт;
 Модуль CO2 основного потока, «Масимо», модель CAT.NO.200101, производитель Masimo Sweden – 1 шт;
 Воздушный адаптер модуля CO2 «Масимо» для новорождённых/младенцев, модель CAT.NO.106260 – 1 шт;
 Модуль бокового потока CO2, «Комен» (115-00001524) - 1 шт;
 Влагосборник «Комен» (040-00001008) – 1 шт;
 Трубка для газоанализа, «Комен» (040-00000939) - 1 шт;
 Назальная канюля для проб CO2 для новорожденных, 2,5 м (040-00001105) - 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instrument Co.,Ltd.
 (Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)
 Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Time piece Building,
 Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shen-zhen, Guandong, 518106, P.R.china

Уполномоченный представитель на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Медстратегия»

(ООО «Медстратегия»)


195299, г. Санкт-Петербург, вн. тер. Г. Муниципальный округ № 21, ул. Киришская, д. 2, литера А, офис часть помещ. 6Н с ном 39.49

Регистрационное удостоверение № XXXXXX от XX.XX.XXXX г.






Датчик температуры, модель СМАТ3101

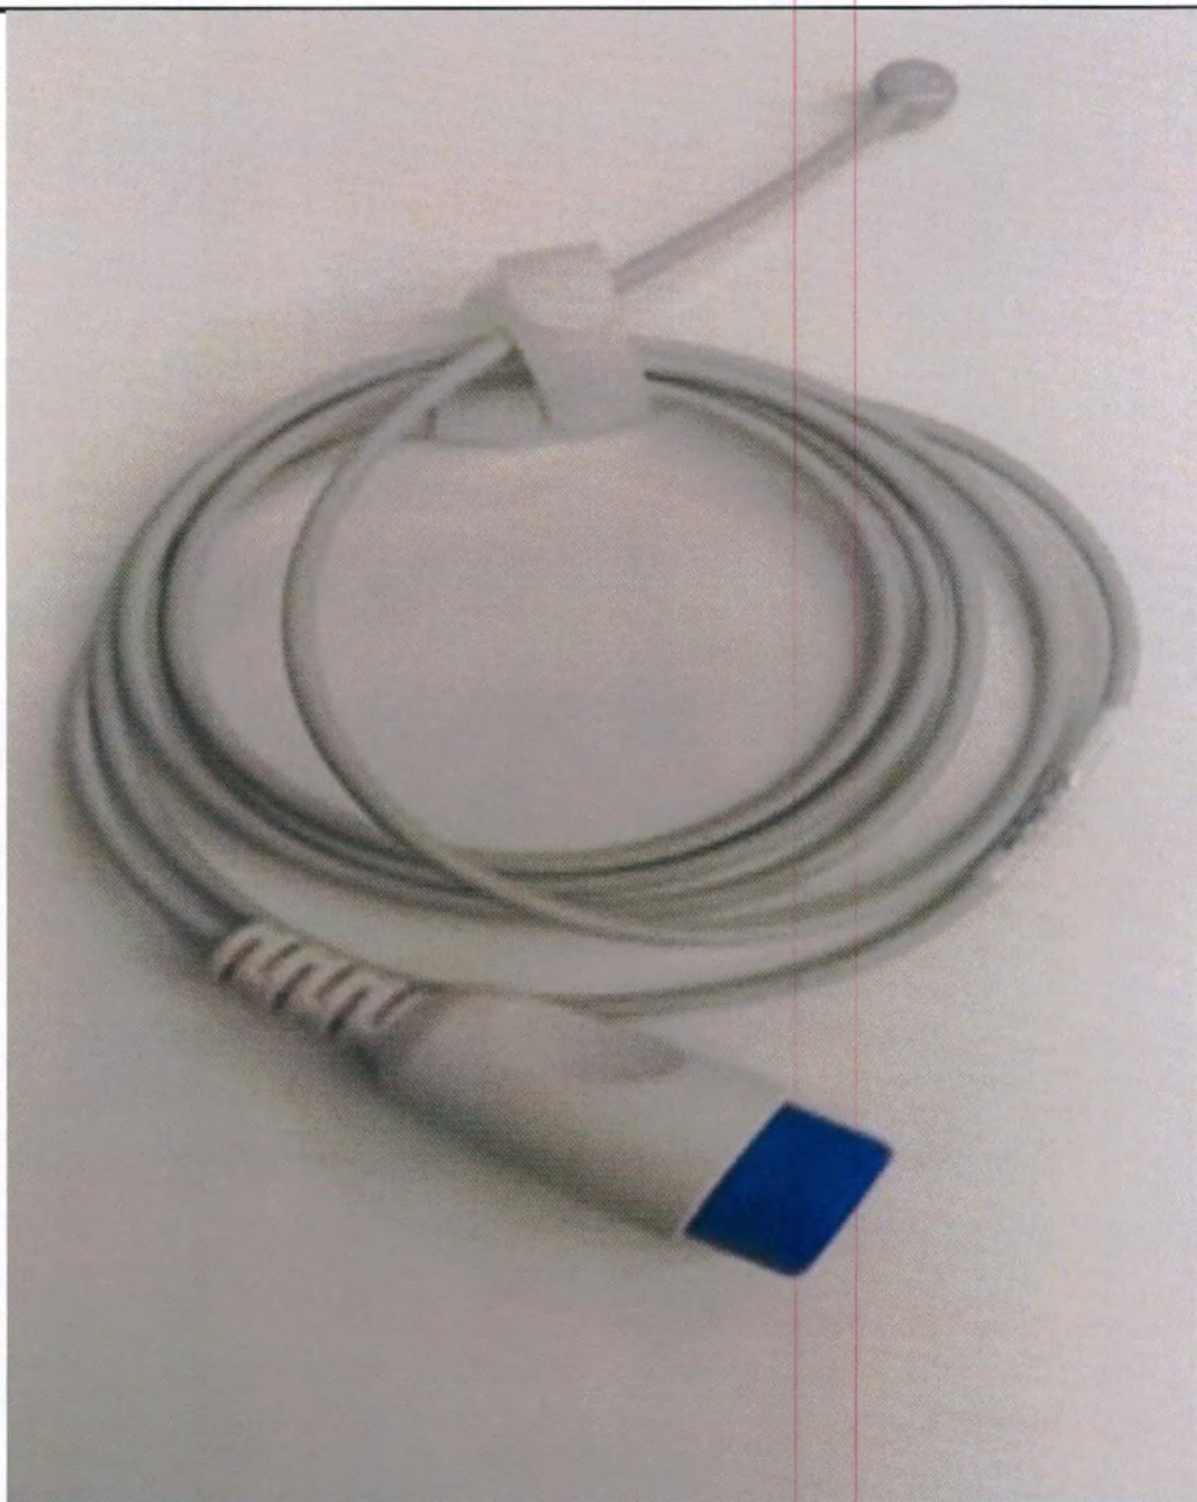


Матрас 693×563мм (040-001071)





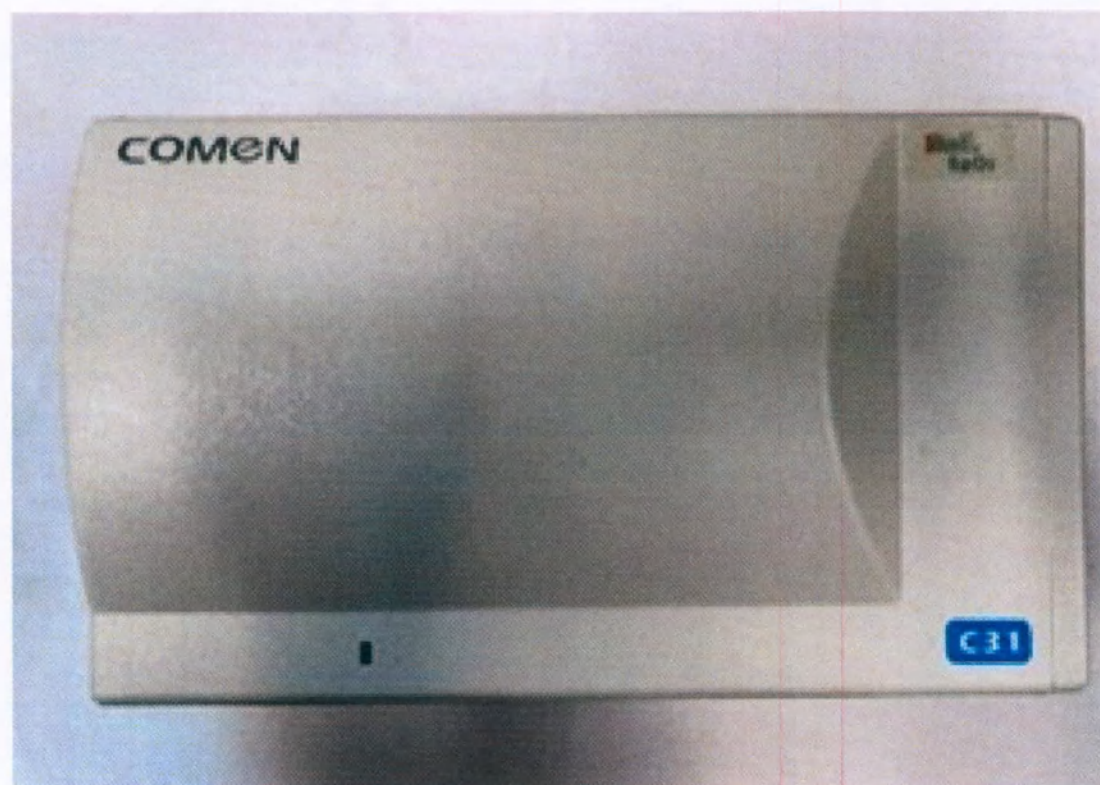


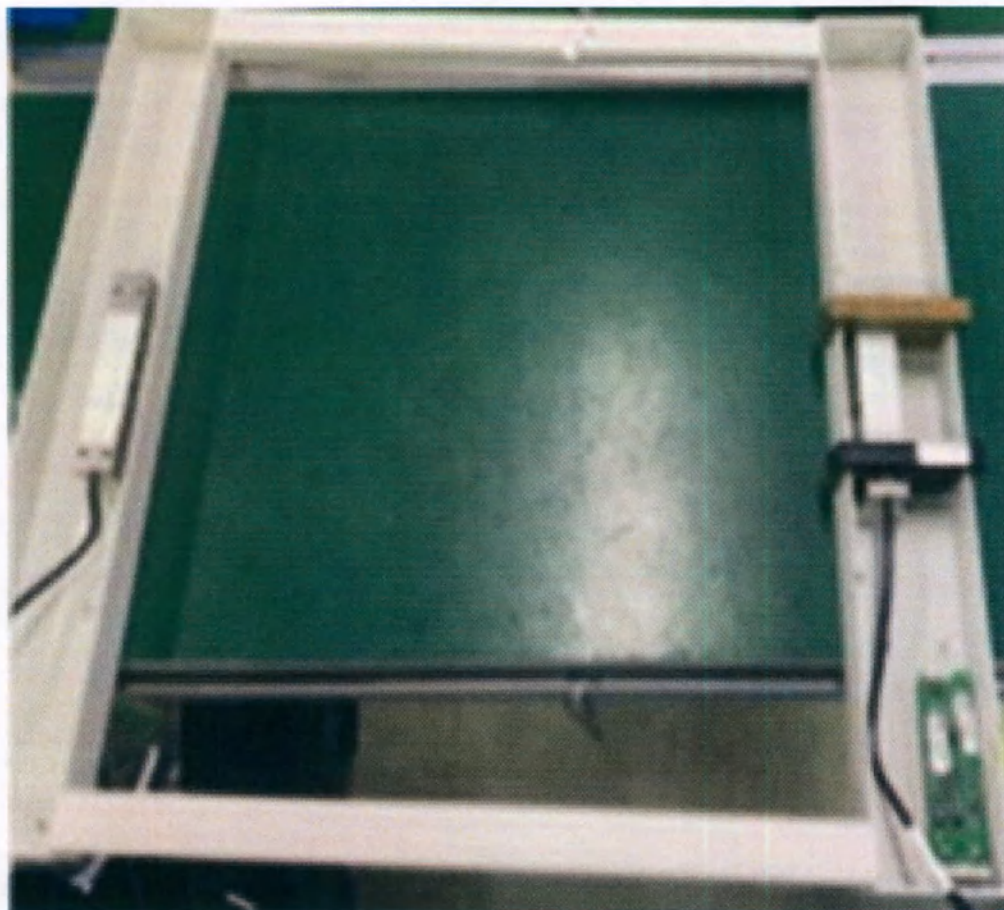

Кабель-удлинитель для ЭКГ на 3 отведения для новорожденных, модель 98ME01EB046




Кабель для ЭКГ на 3 отведения для новорожденных, модель 98ME01AC658

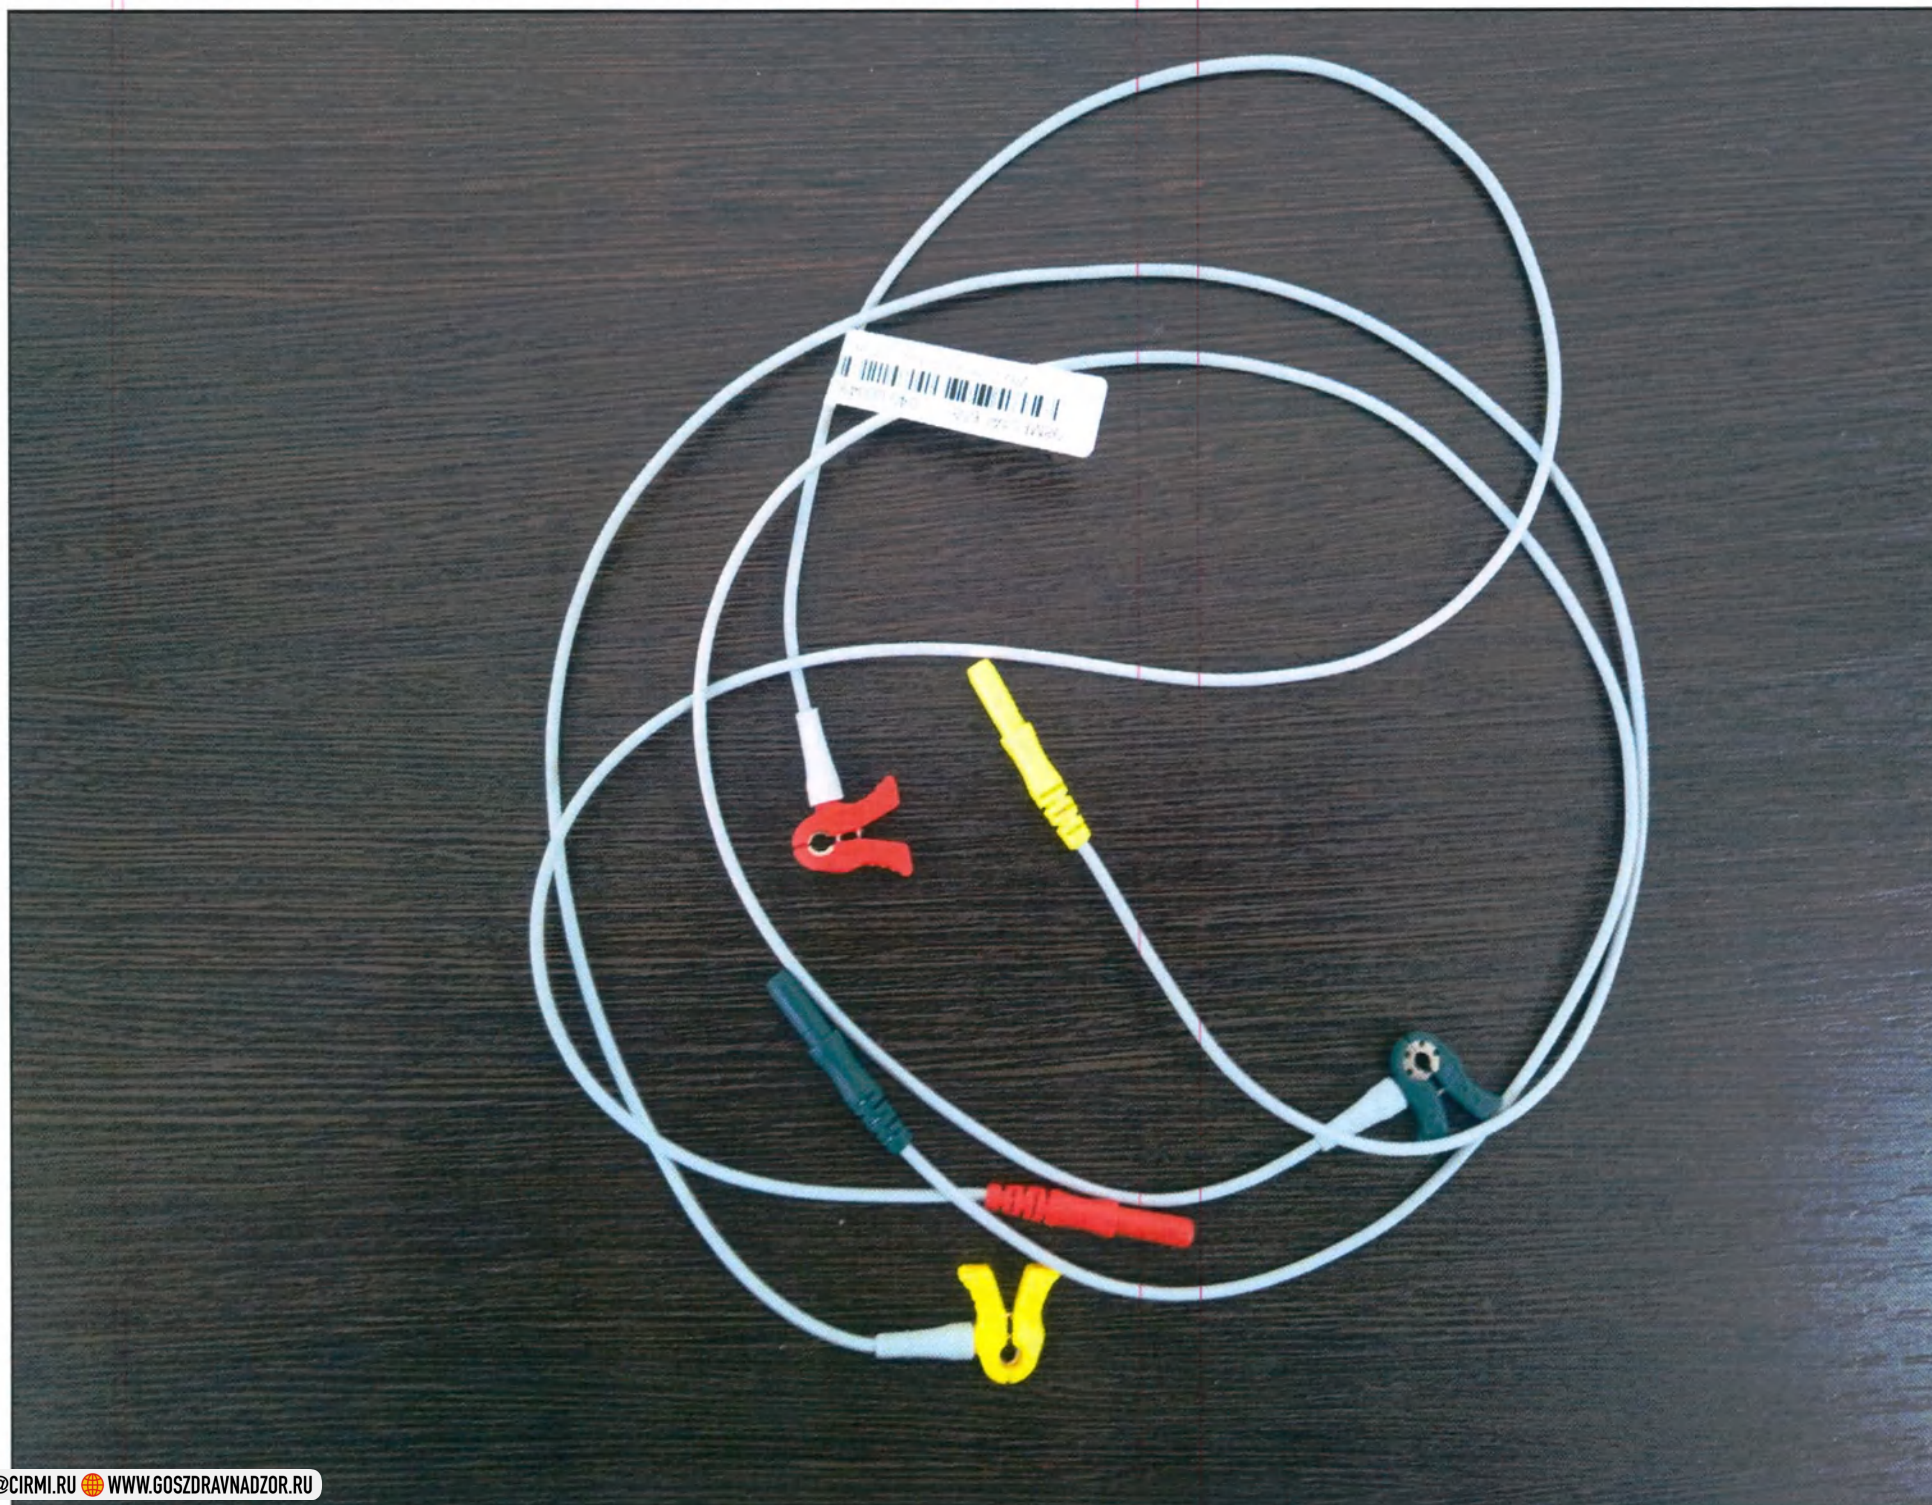

Электрод для электрокардиографии педиатрический, размер: 22х34 мм (каталожный номер 932F2234)


(Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18260 от 15.09.2022г.)

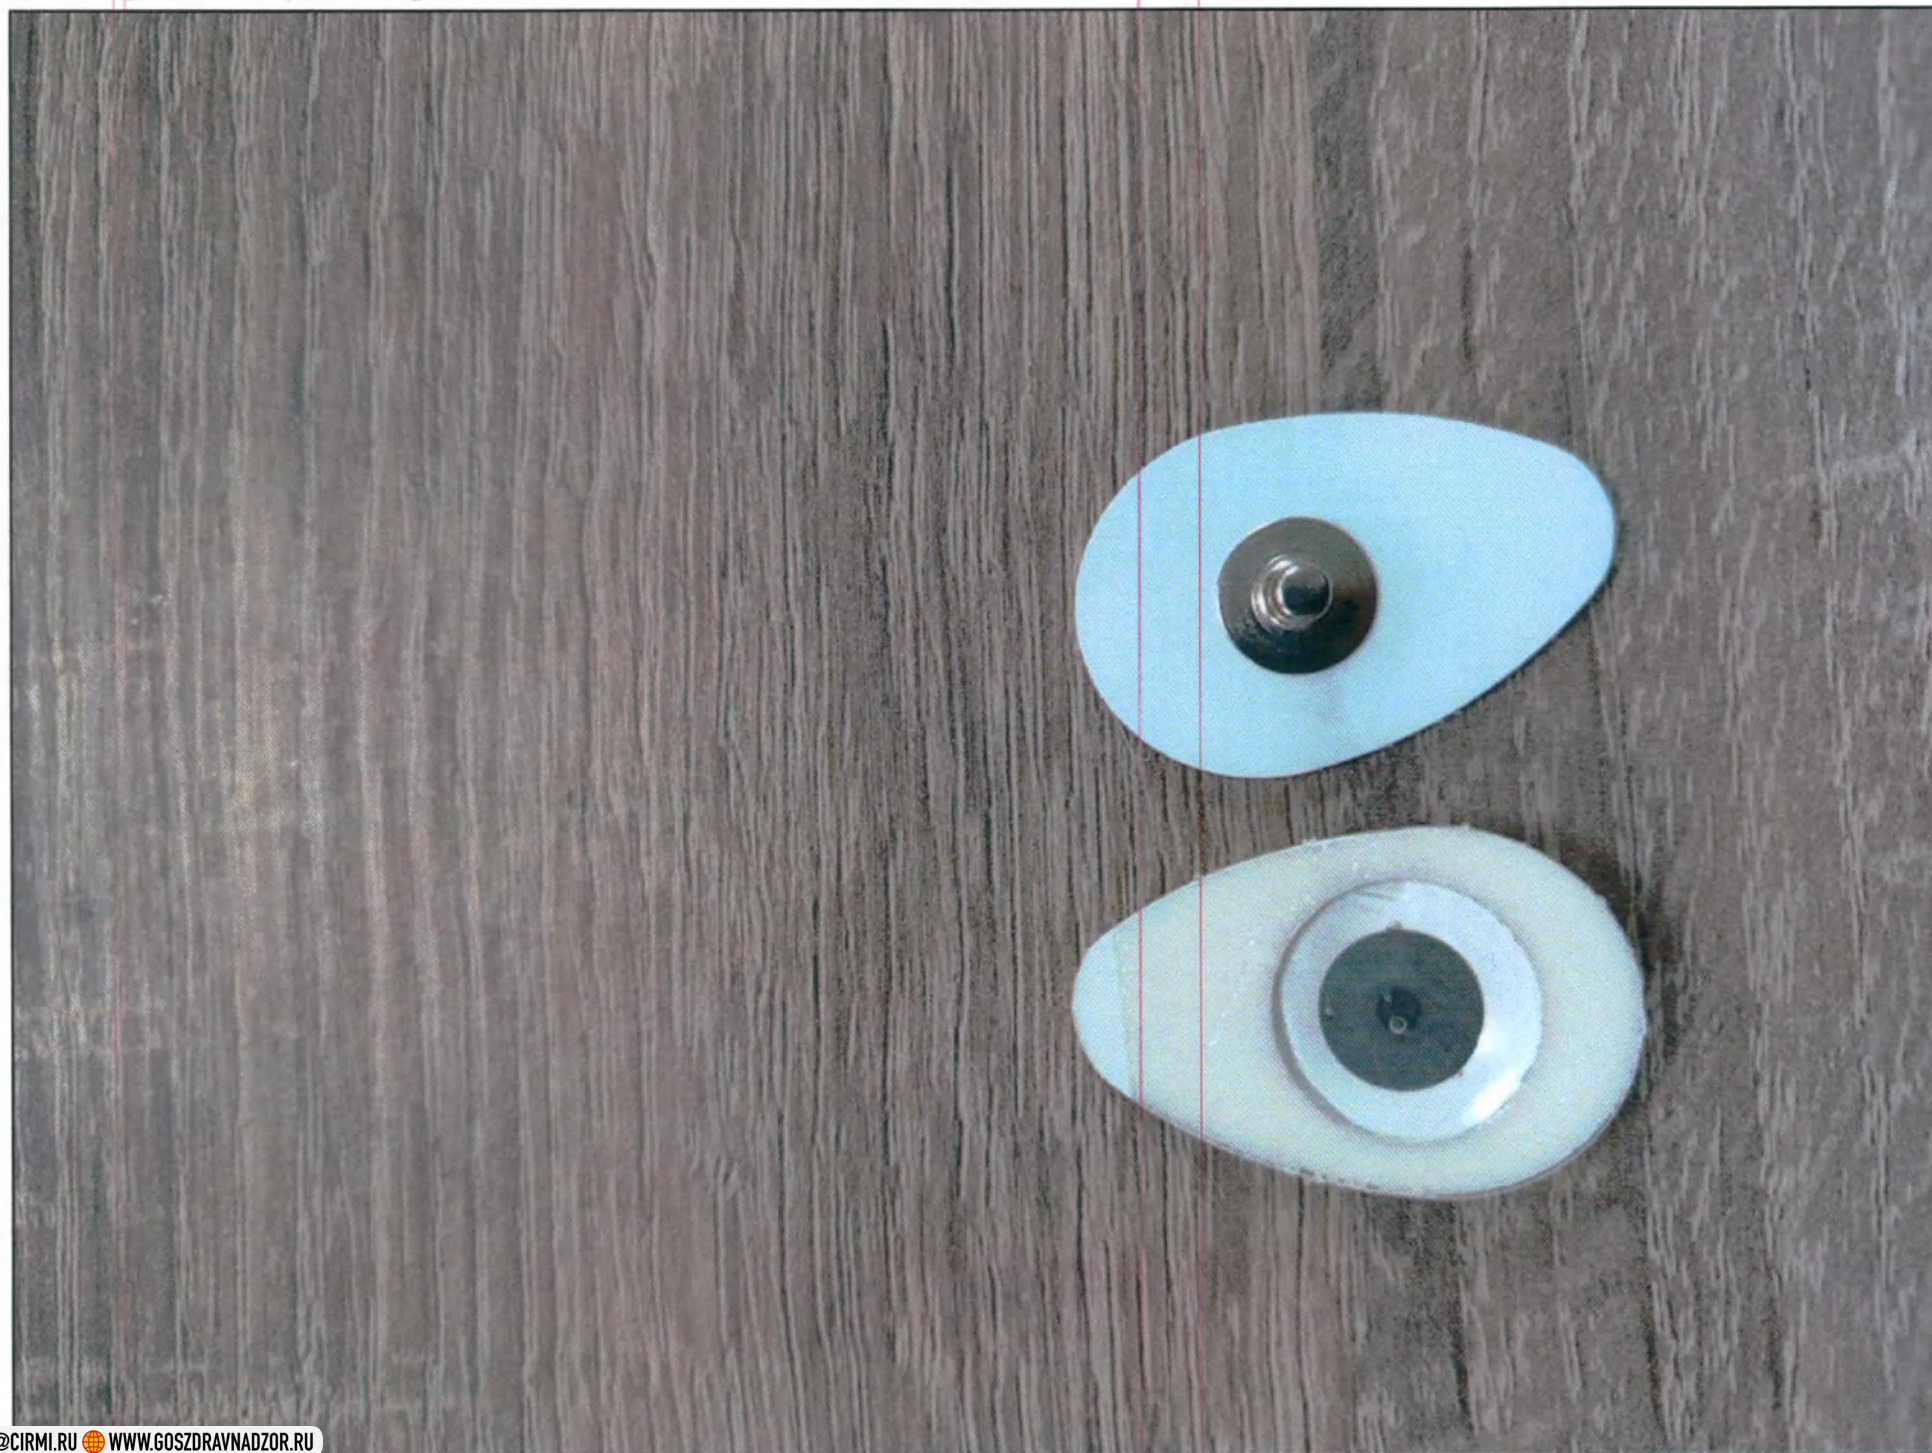


Кабель датчика SpO₂, «Масимо», модель SLZ133



Многоцветный датчик SpO₂ для взрослых/детей/новорожденных, «Масимо», модель RD SET Y1

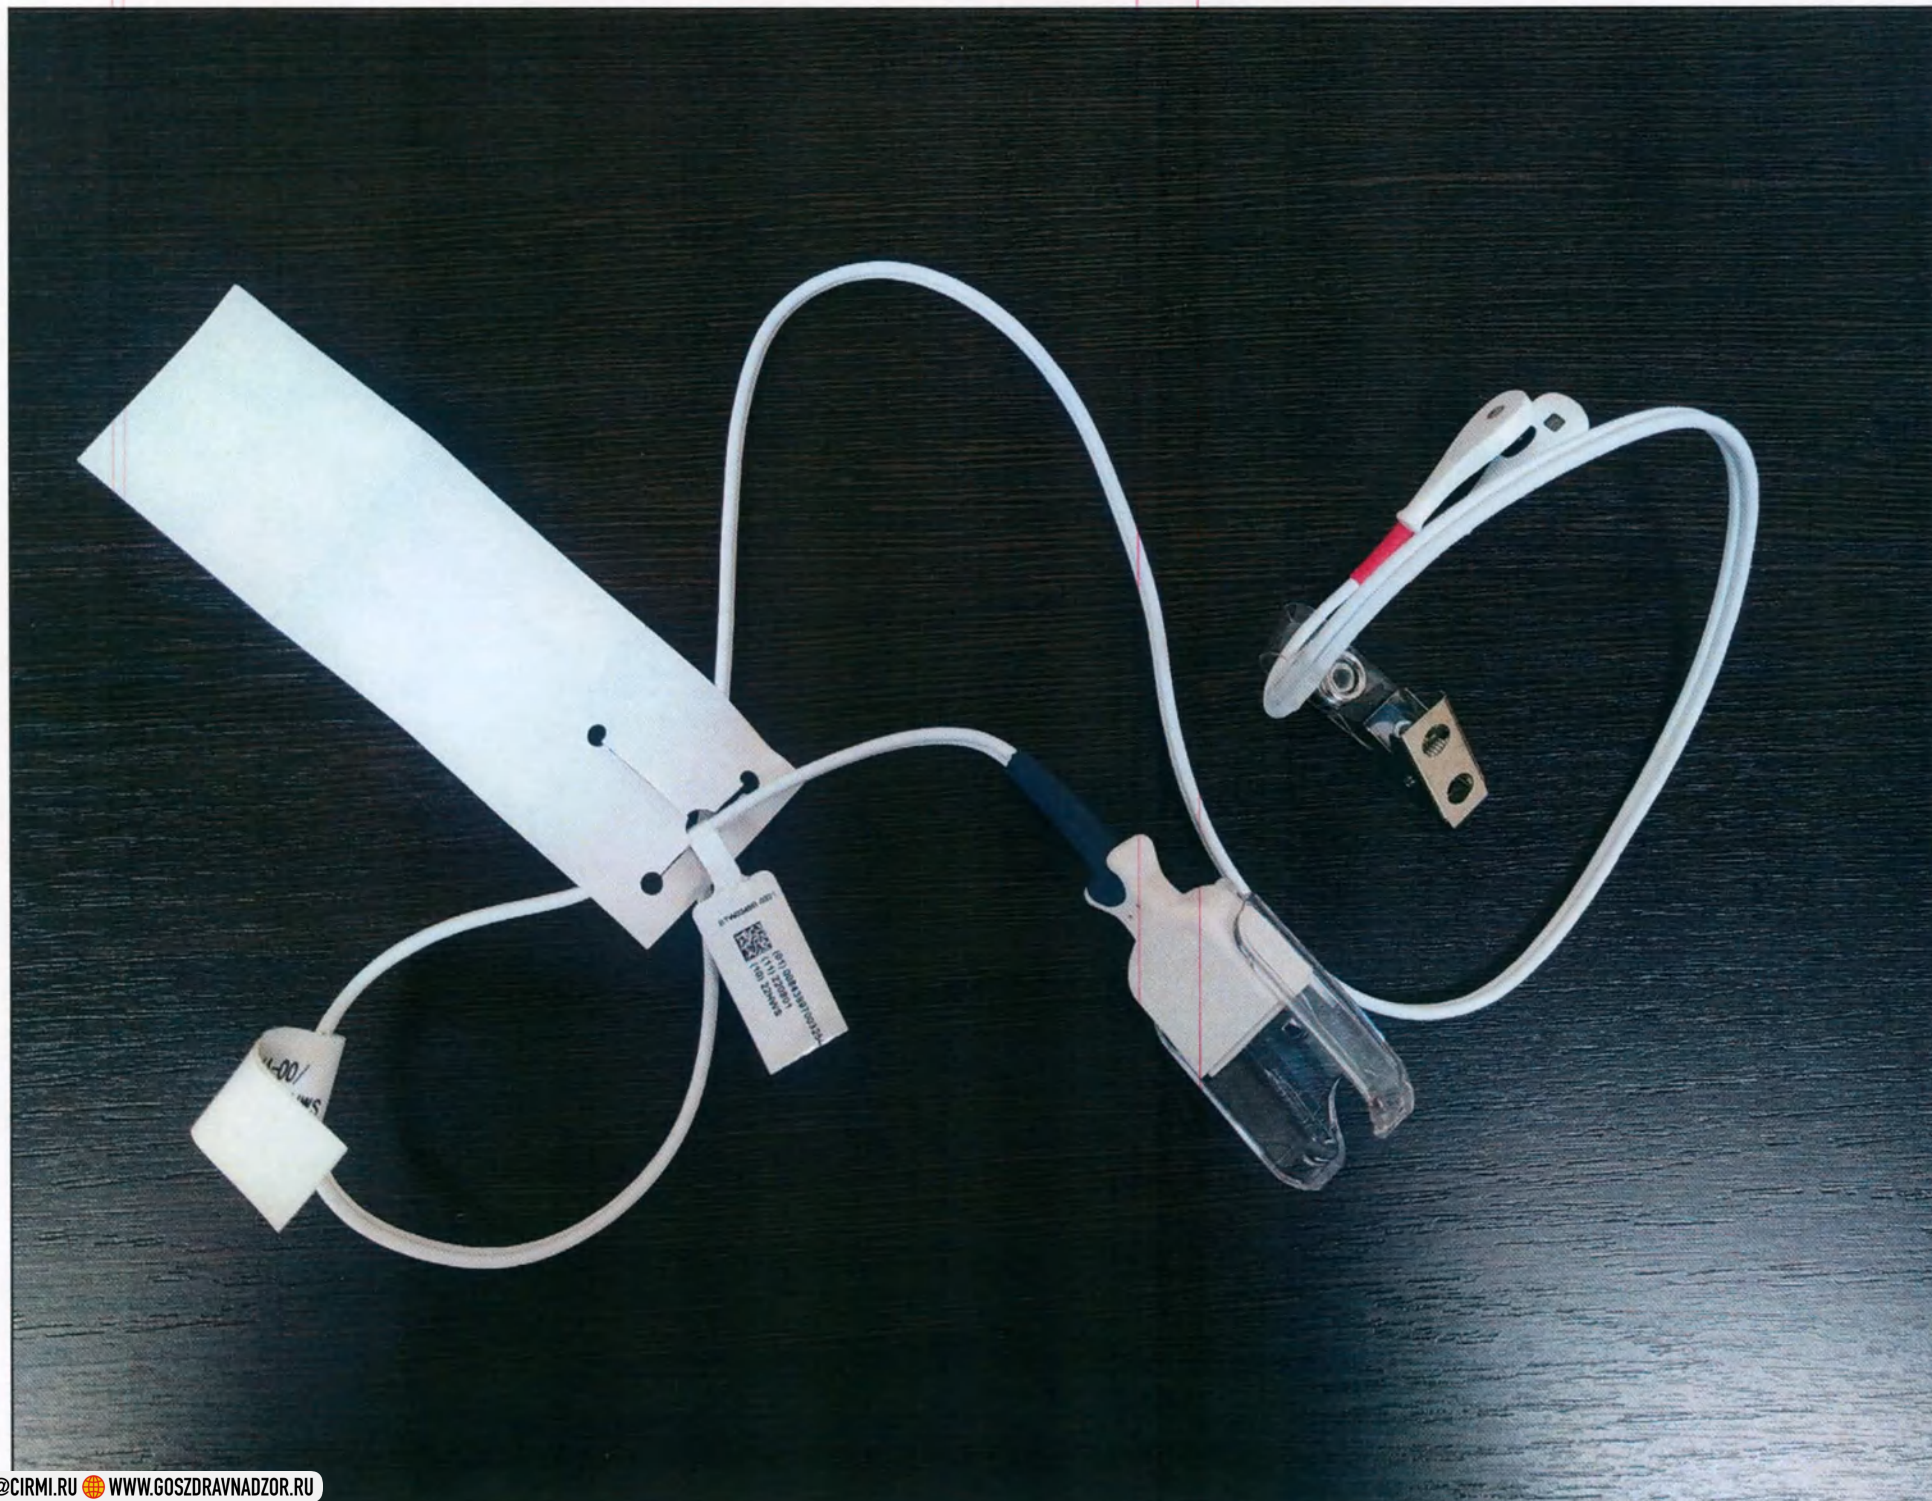


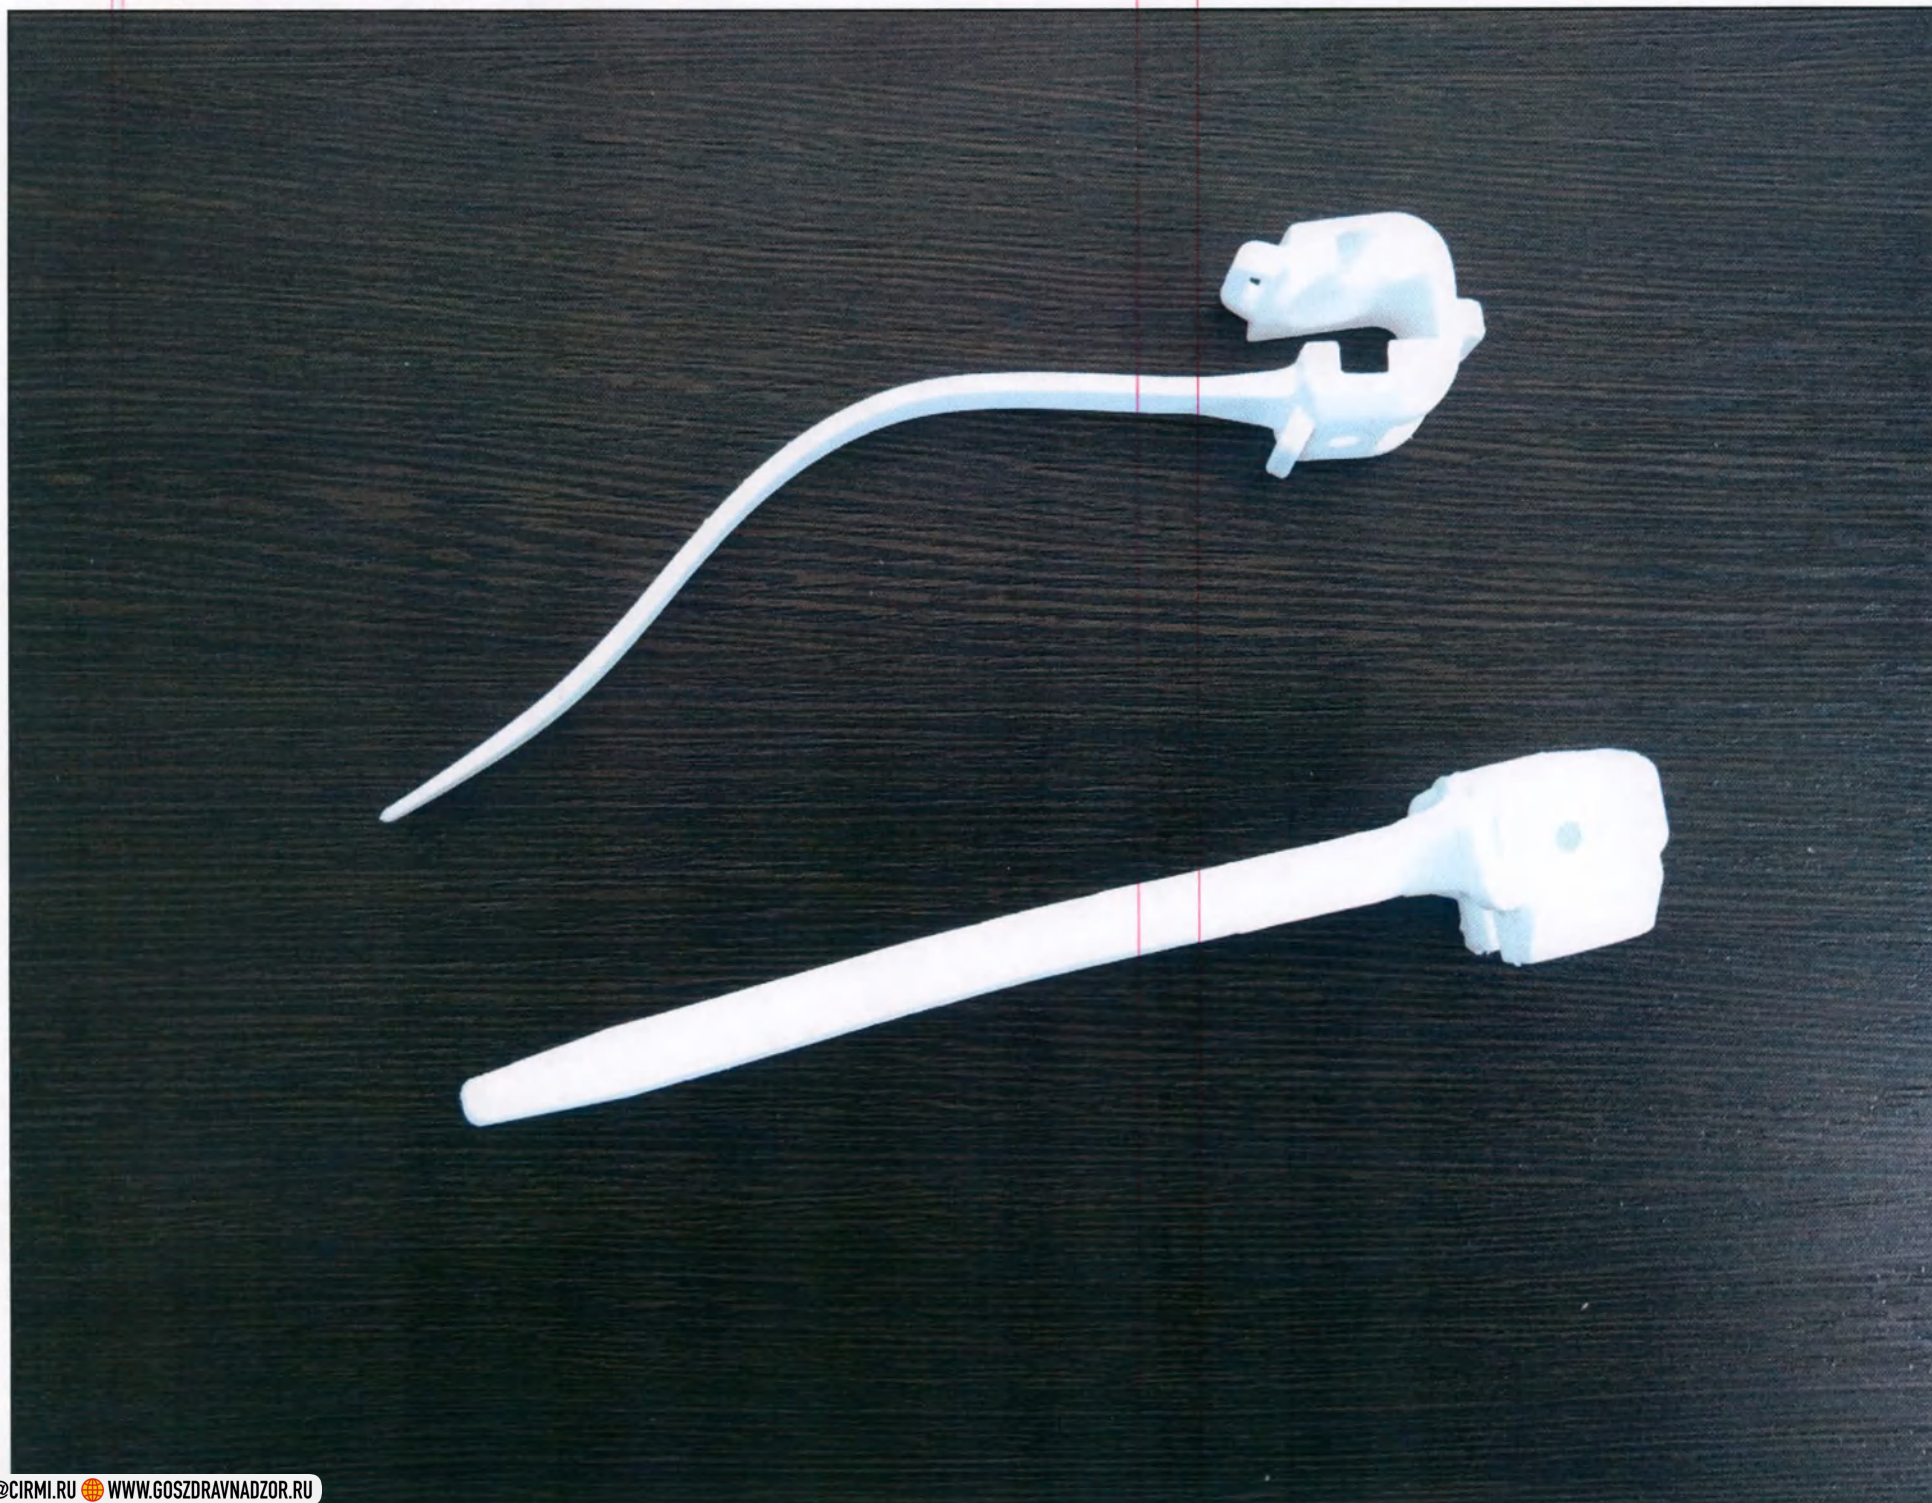

Трубка НИАД 2м для взрослых/детей/новорожденных (040-000808)



Матрас 697×567мм (040-001078)

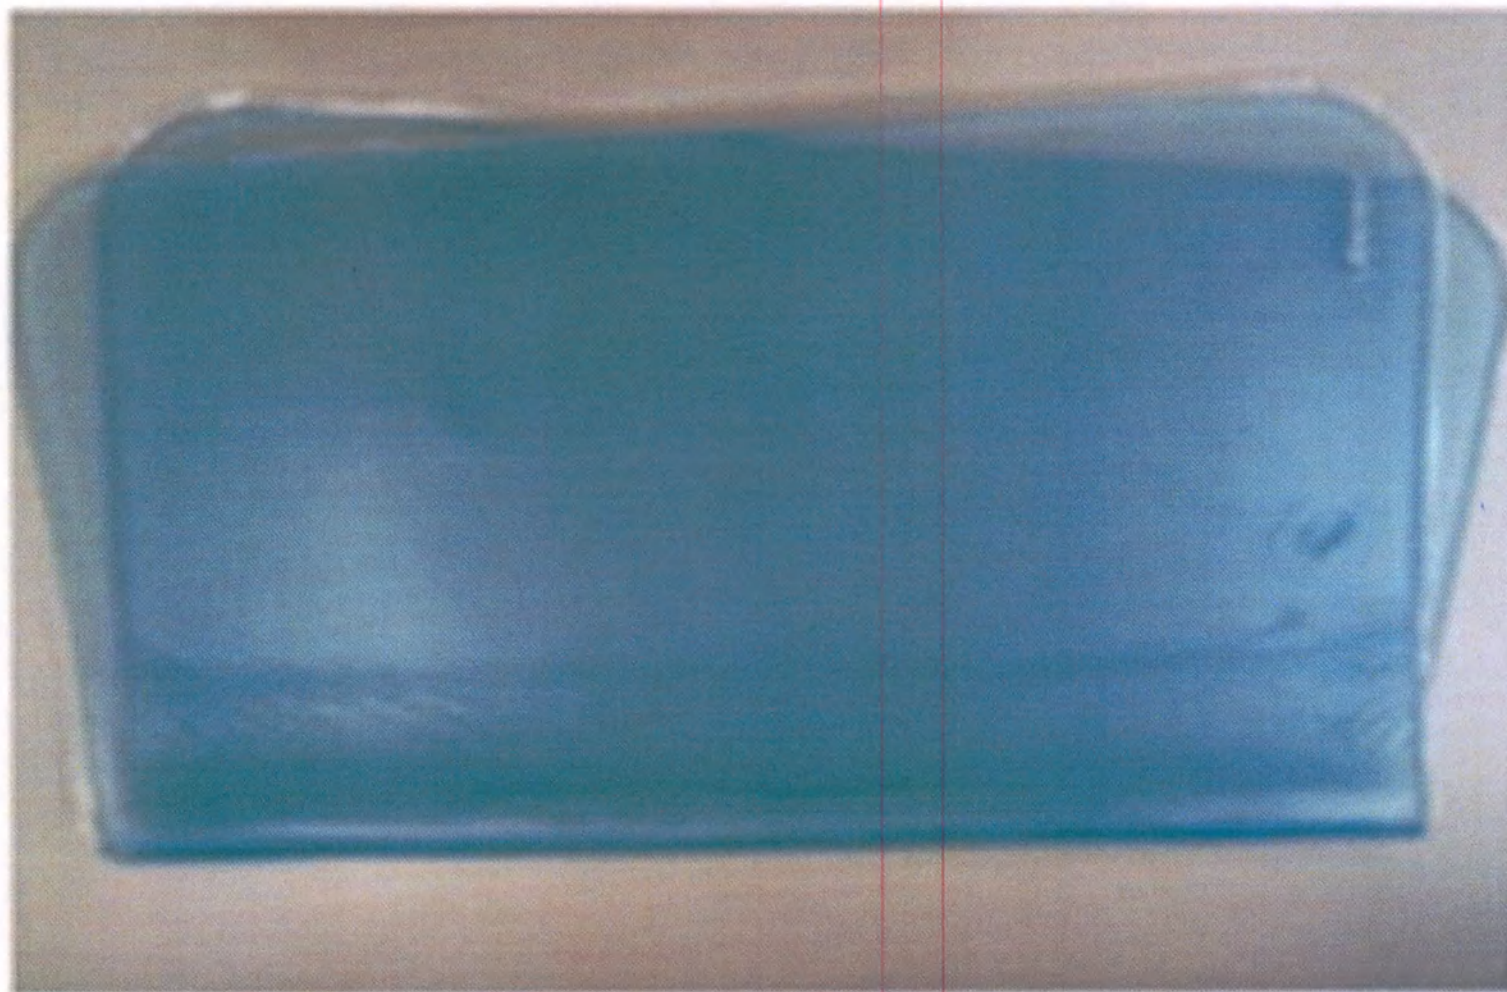

Прямой соединитель, модель G-311063-1




Сборка сильфонного соединения одноразовая, модель DVI200



Вибратор для пробуждения при апноэ для новорожденных, модель A0916-C05



Набор аксессуаров для увлажнения (115-00004230)

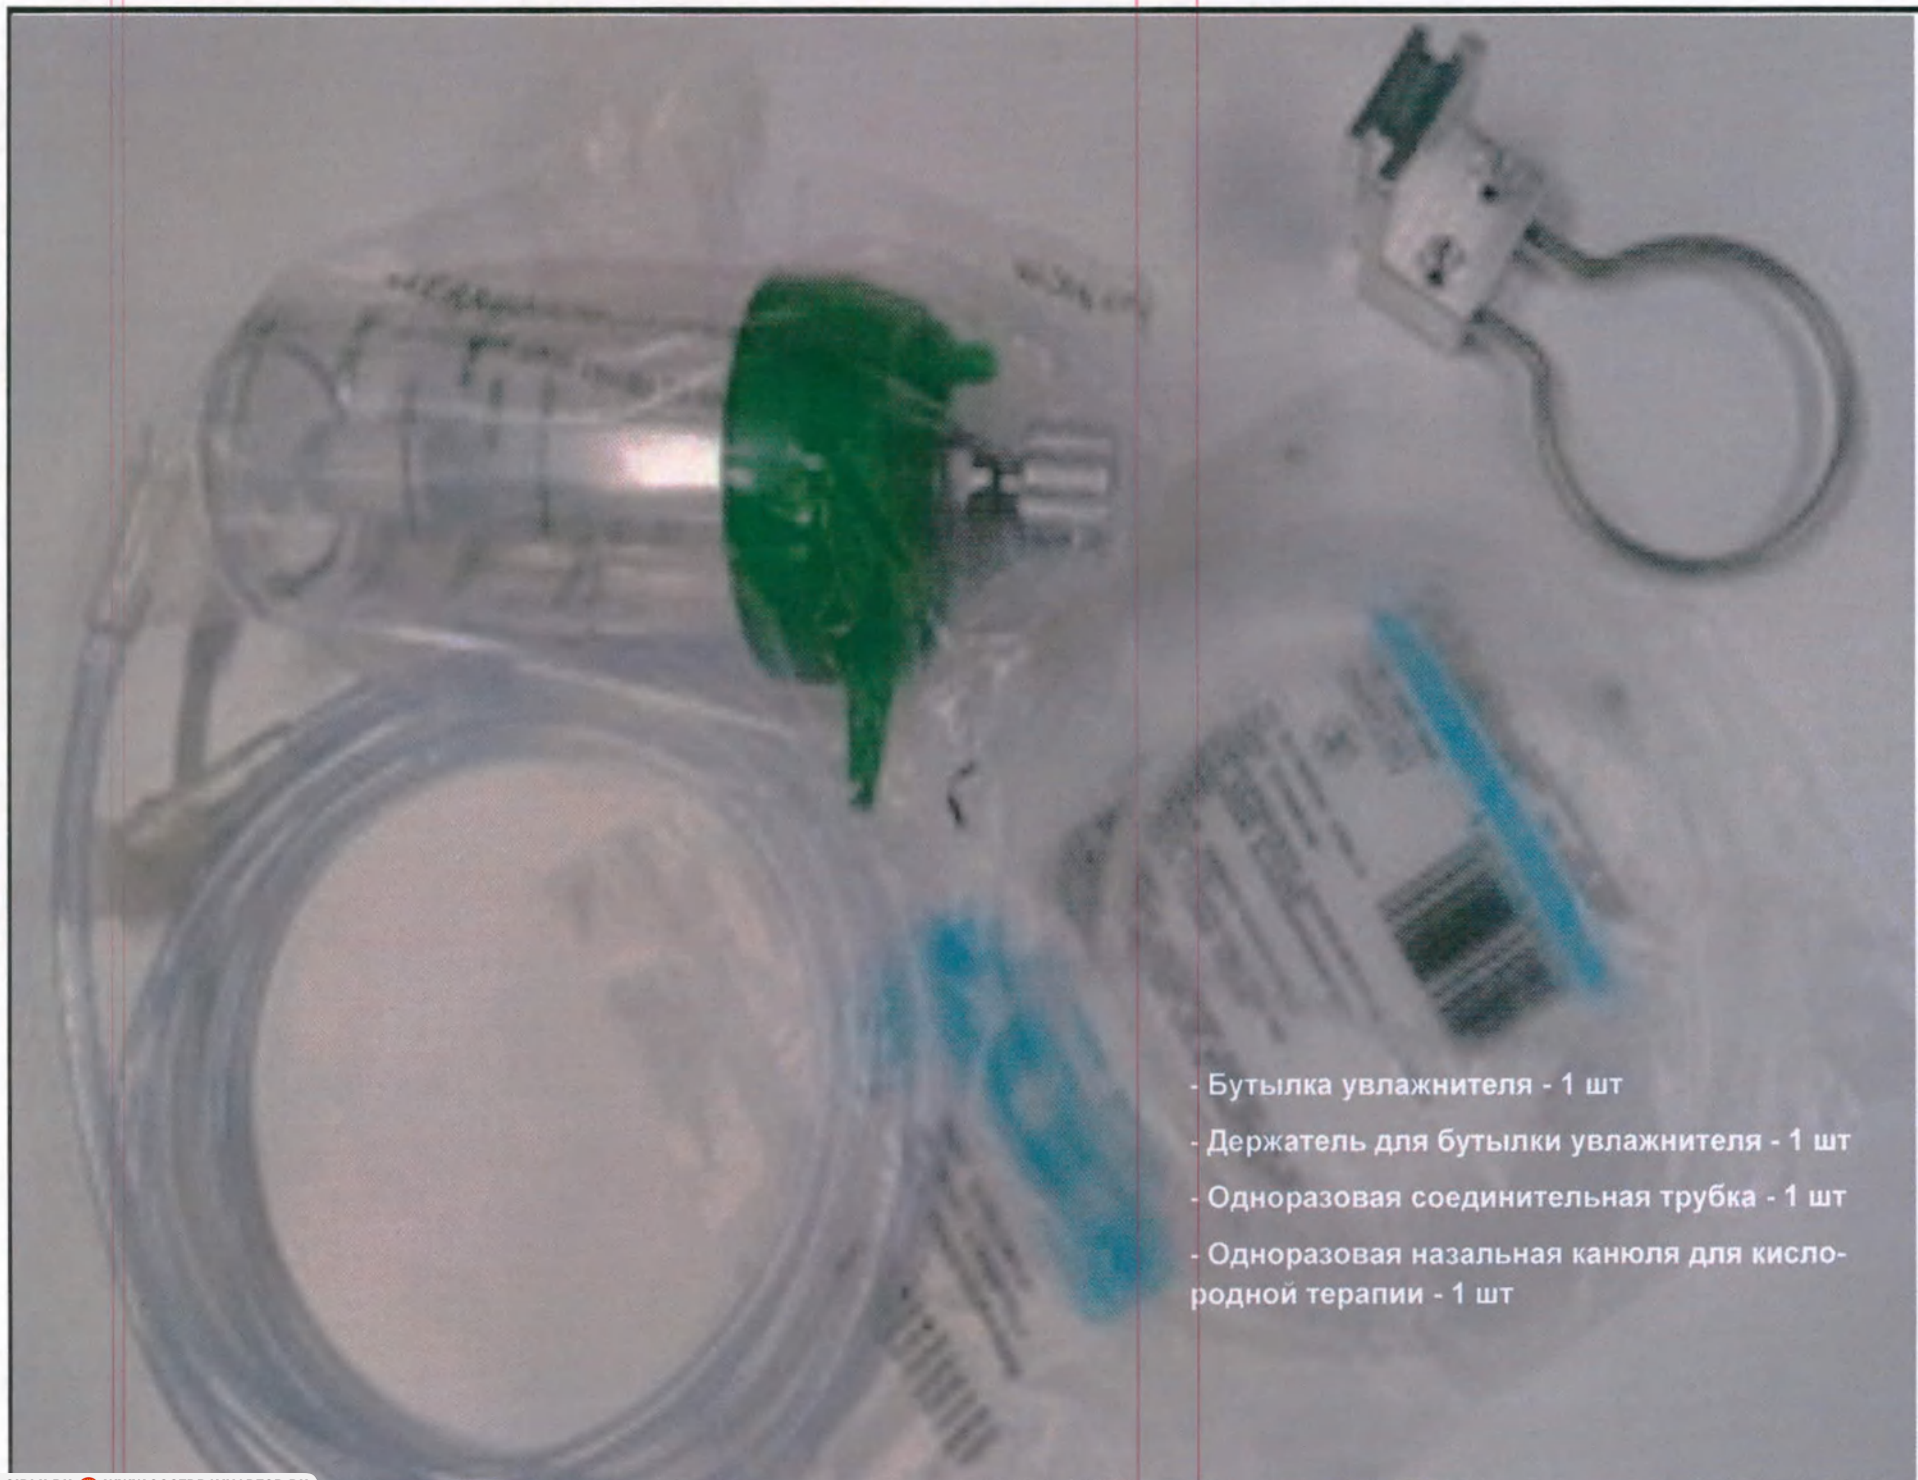

- Бутылка увлажнителя - 1 шт
- Держатель для бутылки увлажнителя - 1 шт
- Одноразовая соединительная трубка - 1 шт
- Одноразовая назальная канюля для кислородной терапии - 1 шт

Шланг для кислородного газа (040-000848)



Шланг для воздуха и газа (040-000849)








- Держатель бутылки, фиксированный - 1 шт
- Бутылка для сбора жидкости 1000 мл - 1 шт
- Соединительная трубка с фильтром - 1 шт


Зажим для газового шланга (034-000006)

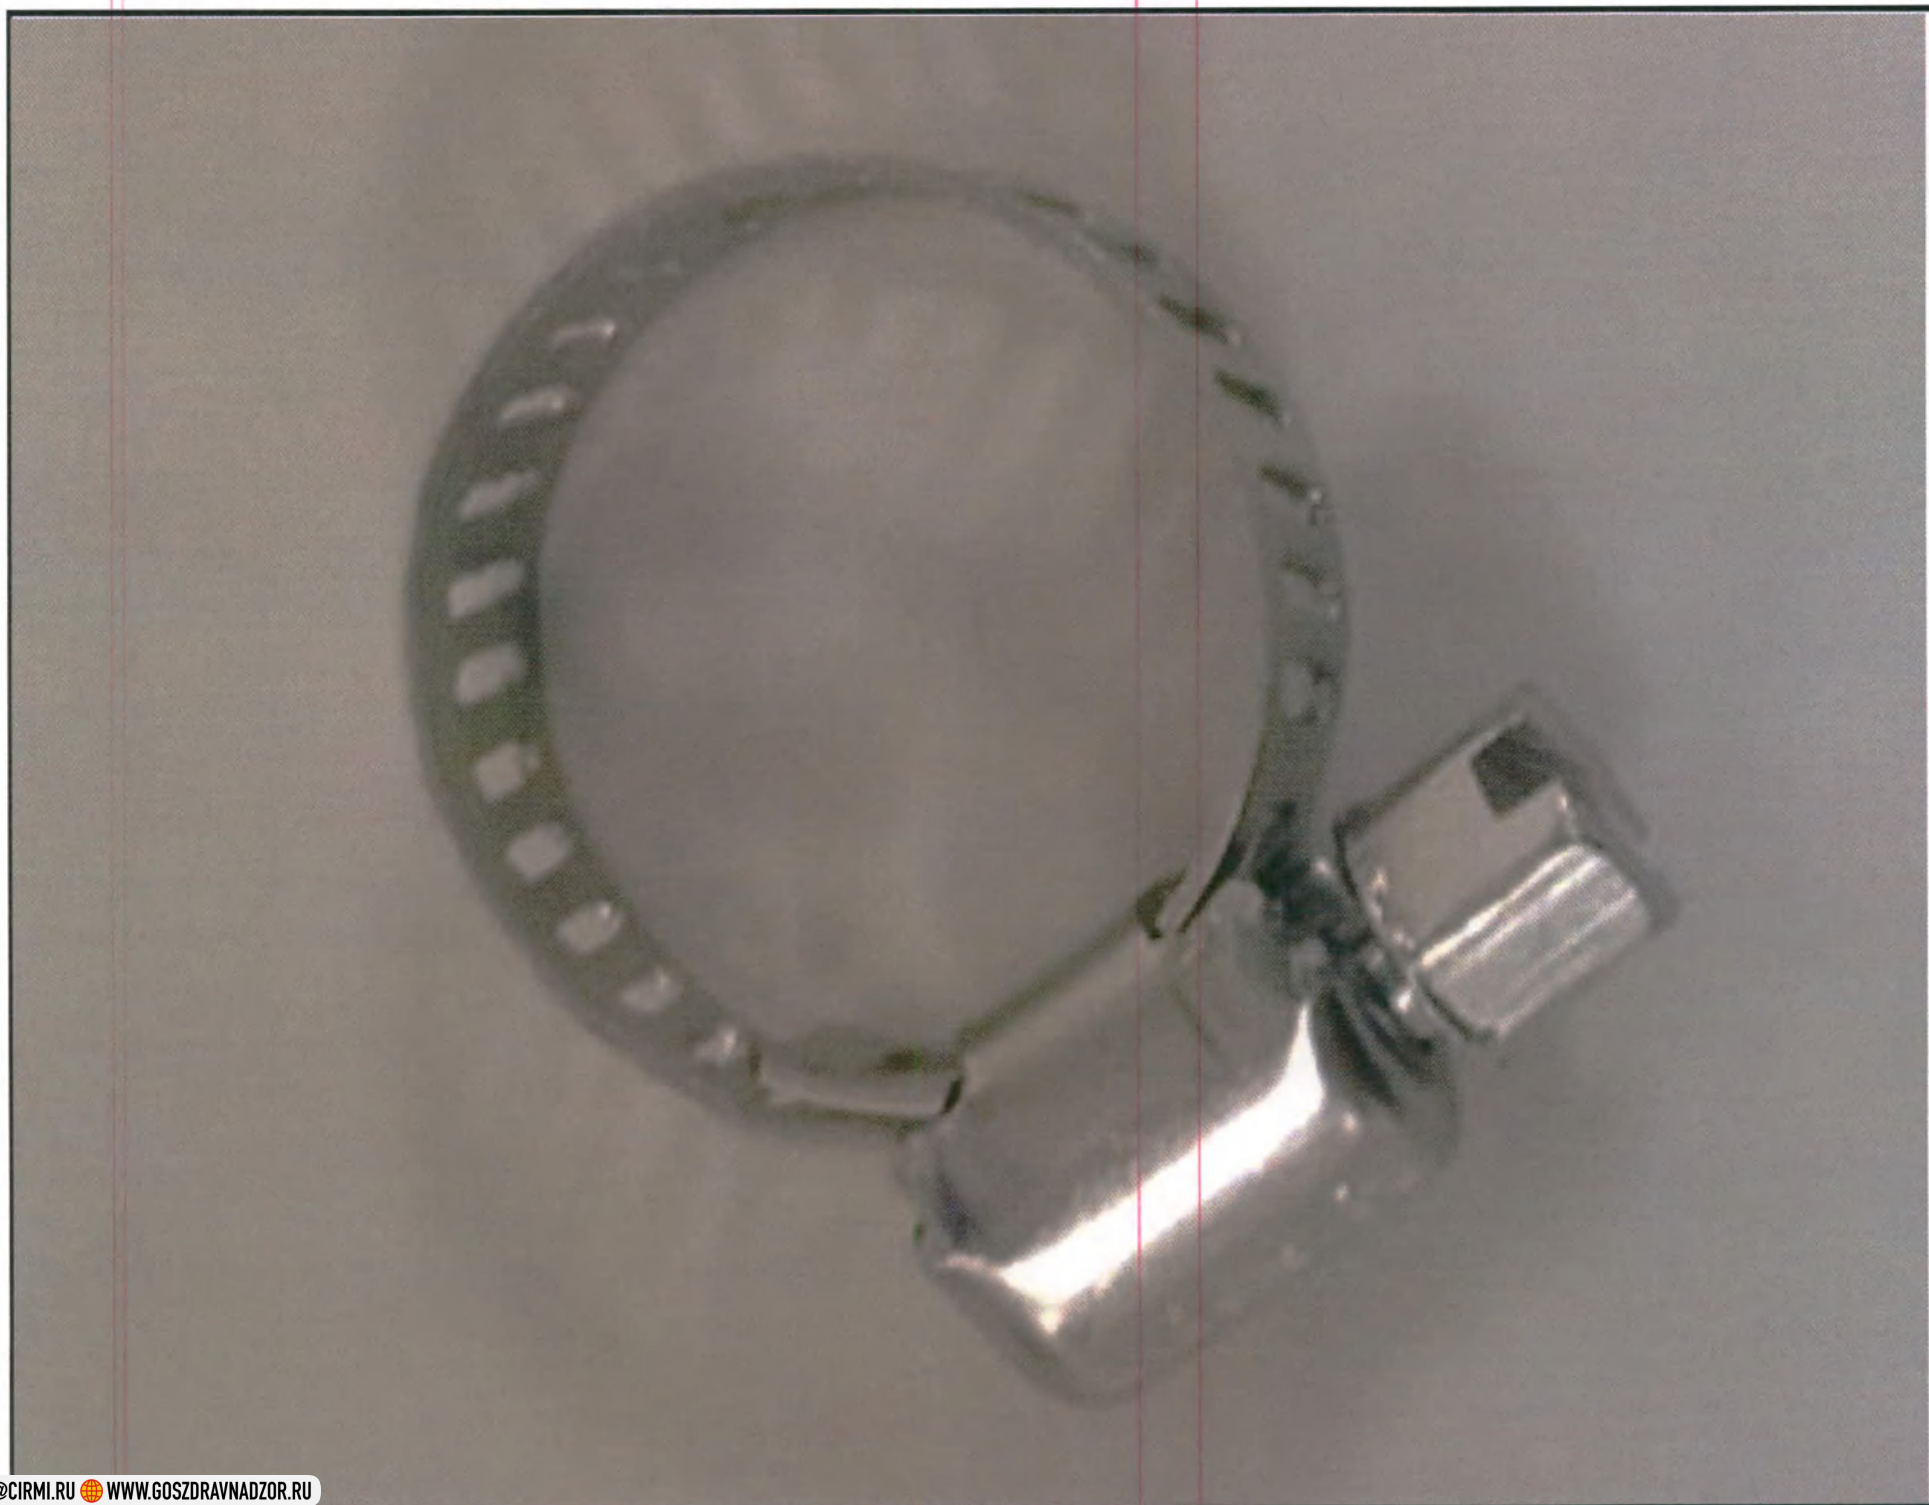



Адаптер-кислород (041-001815)





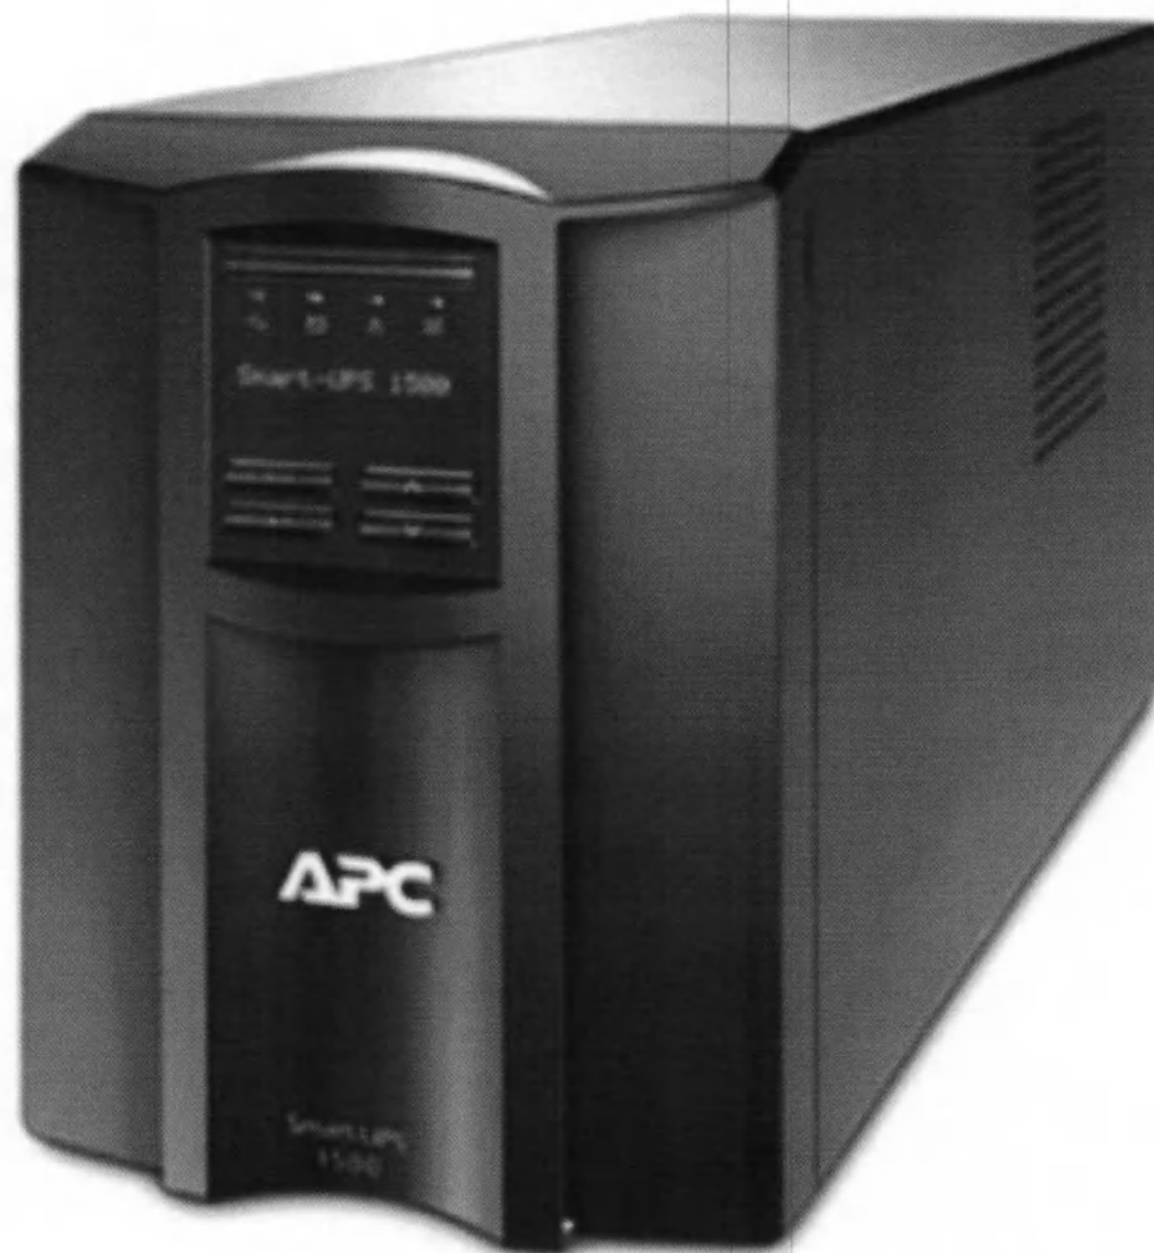

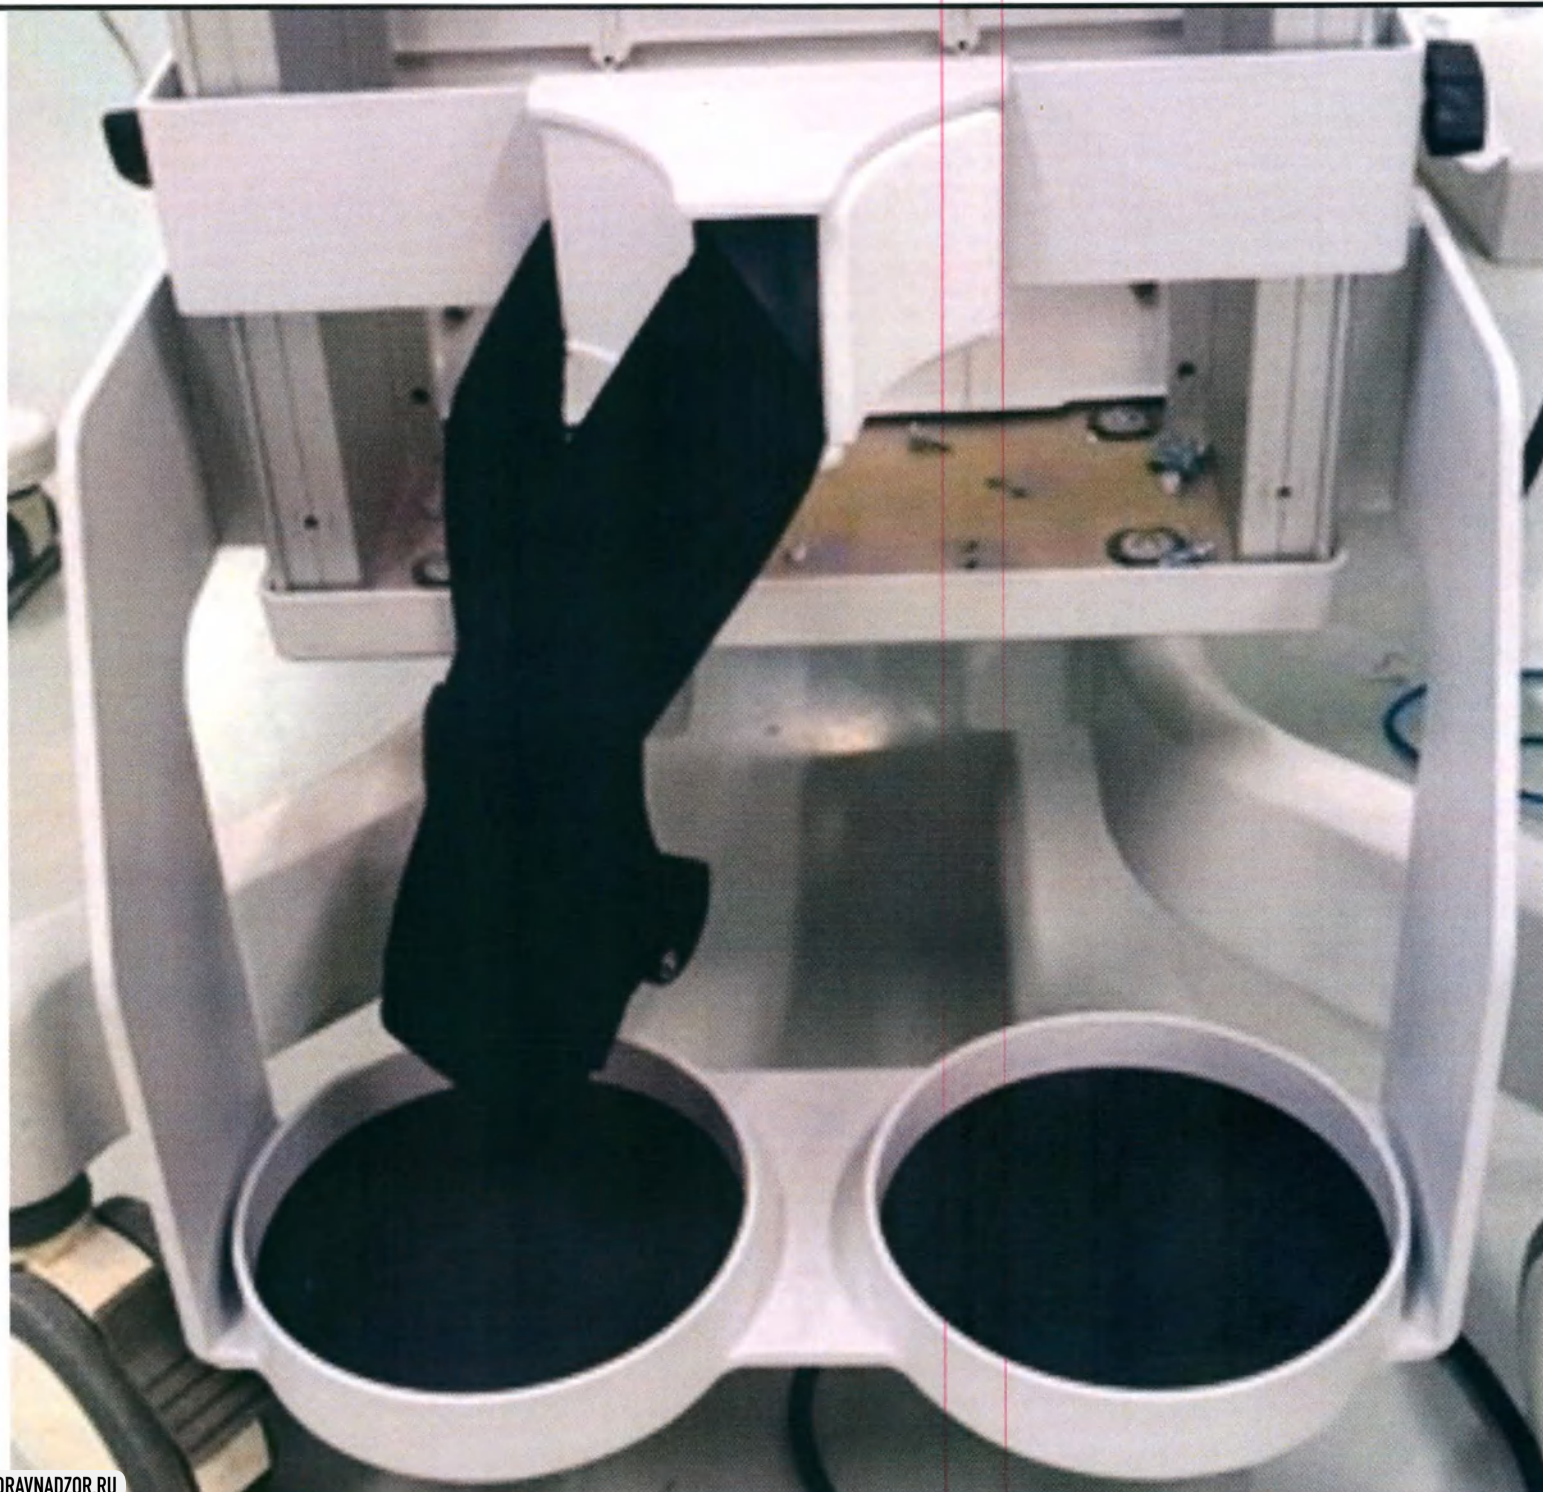


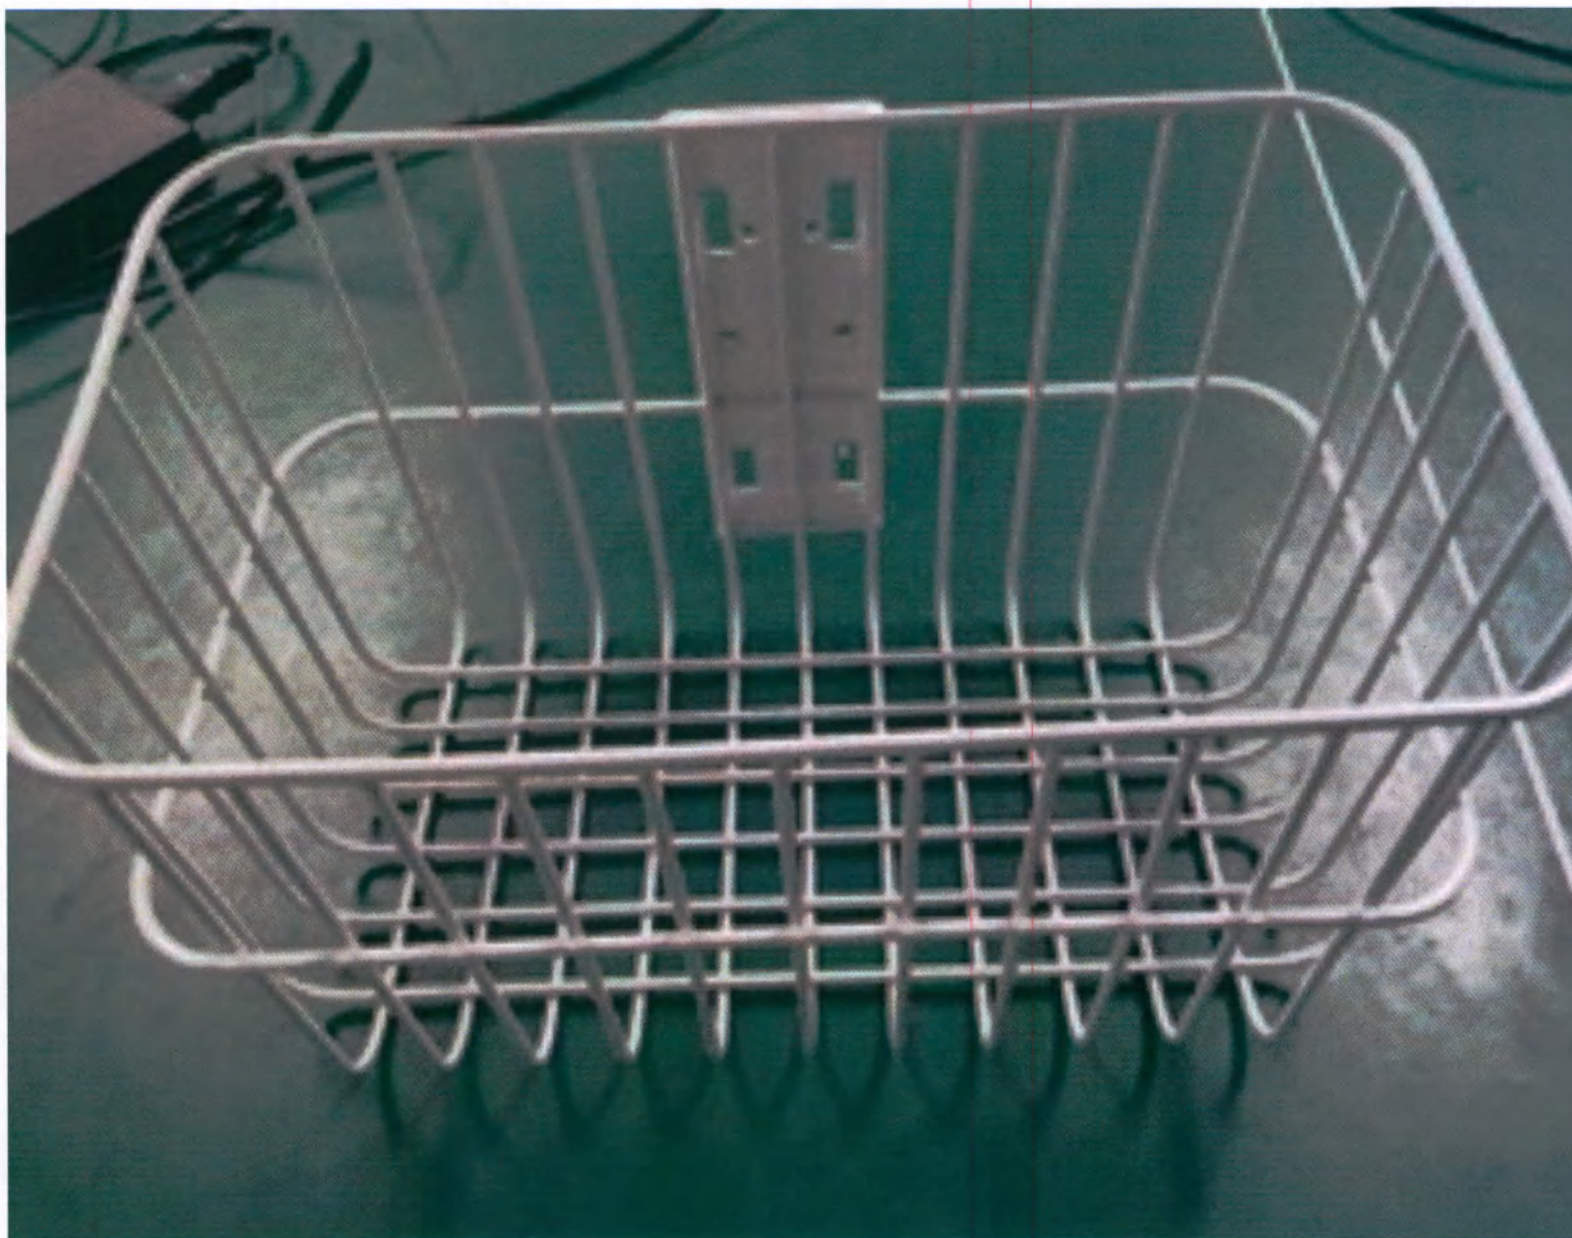


Трубка НИАД 3м для взрослых/детей/новорожденных, модель СМАНОВ01



Опорный рычаг дыхательного контура (115-00004539)

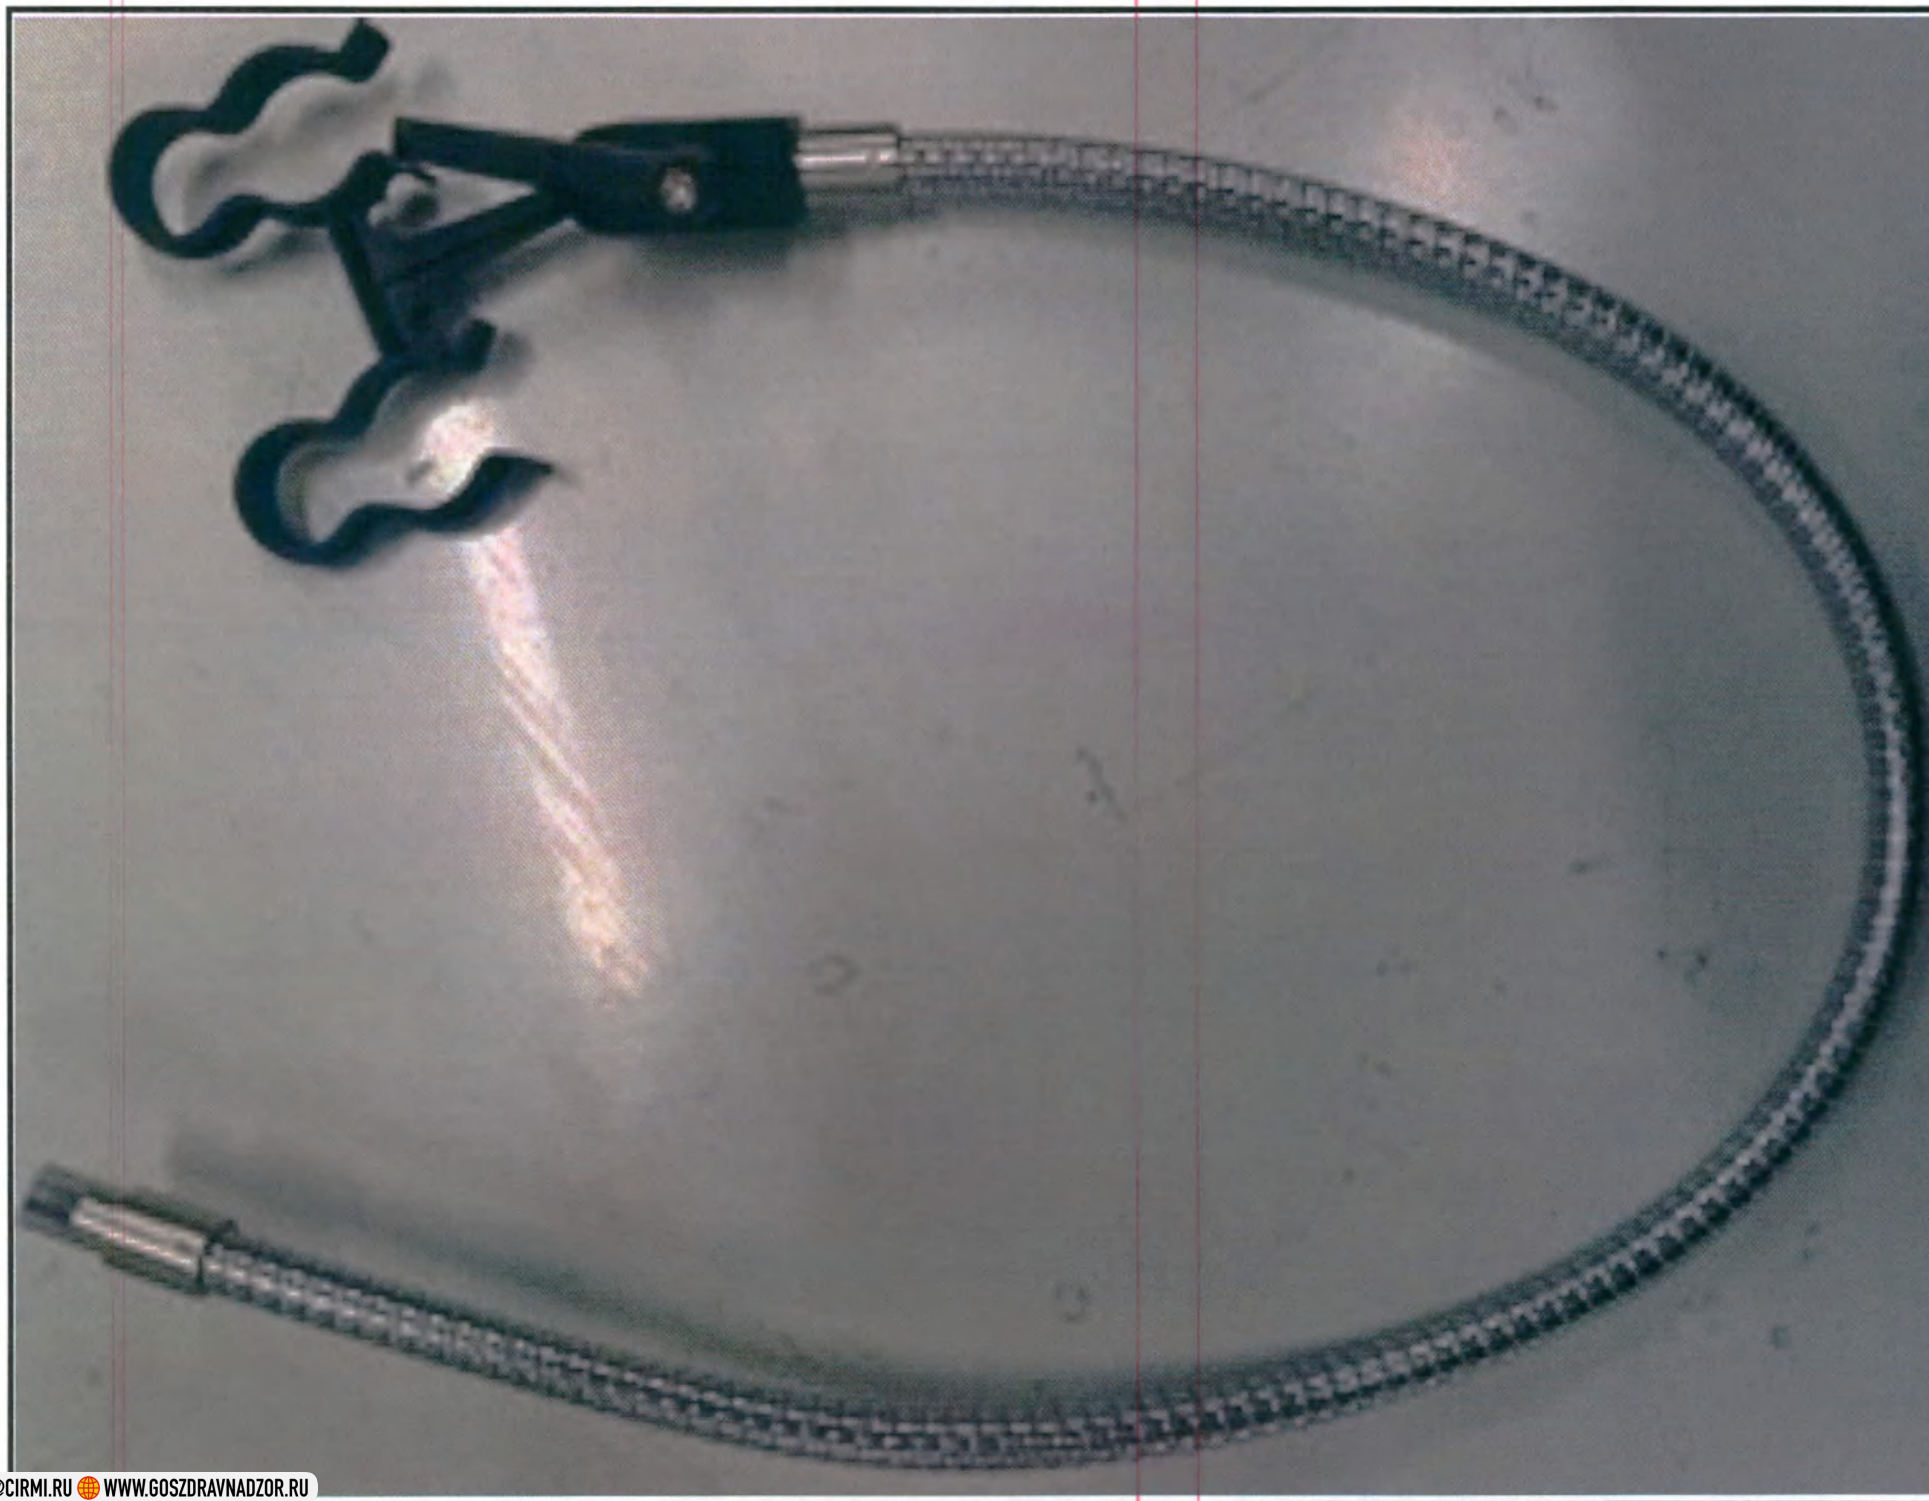


Модуль CO2 бокового потока, «Масимо», модель 4410

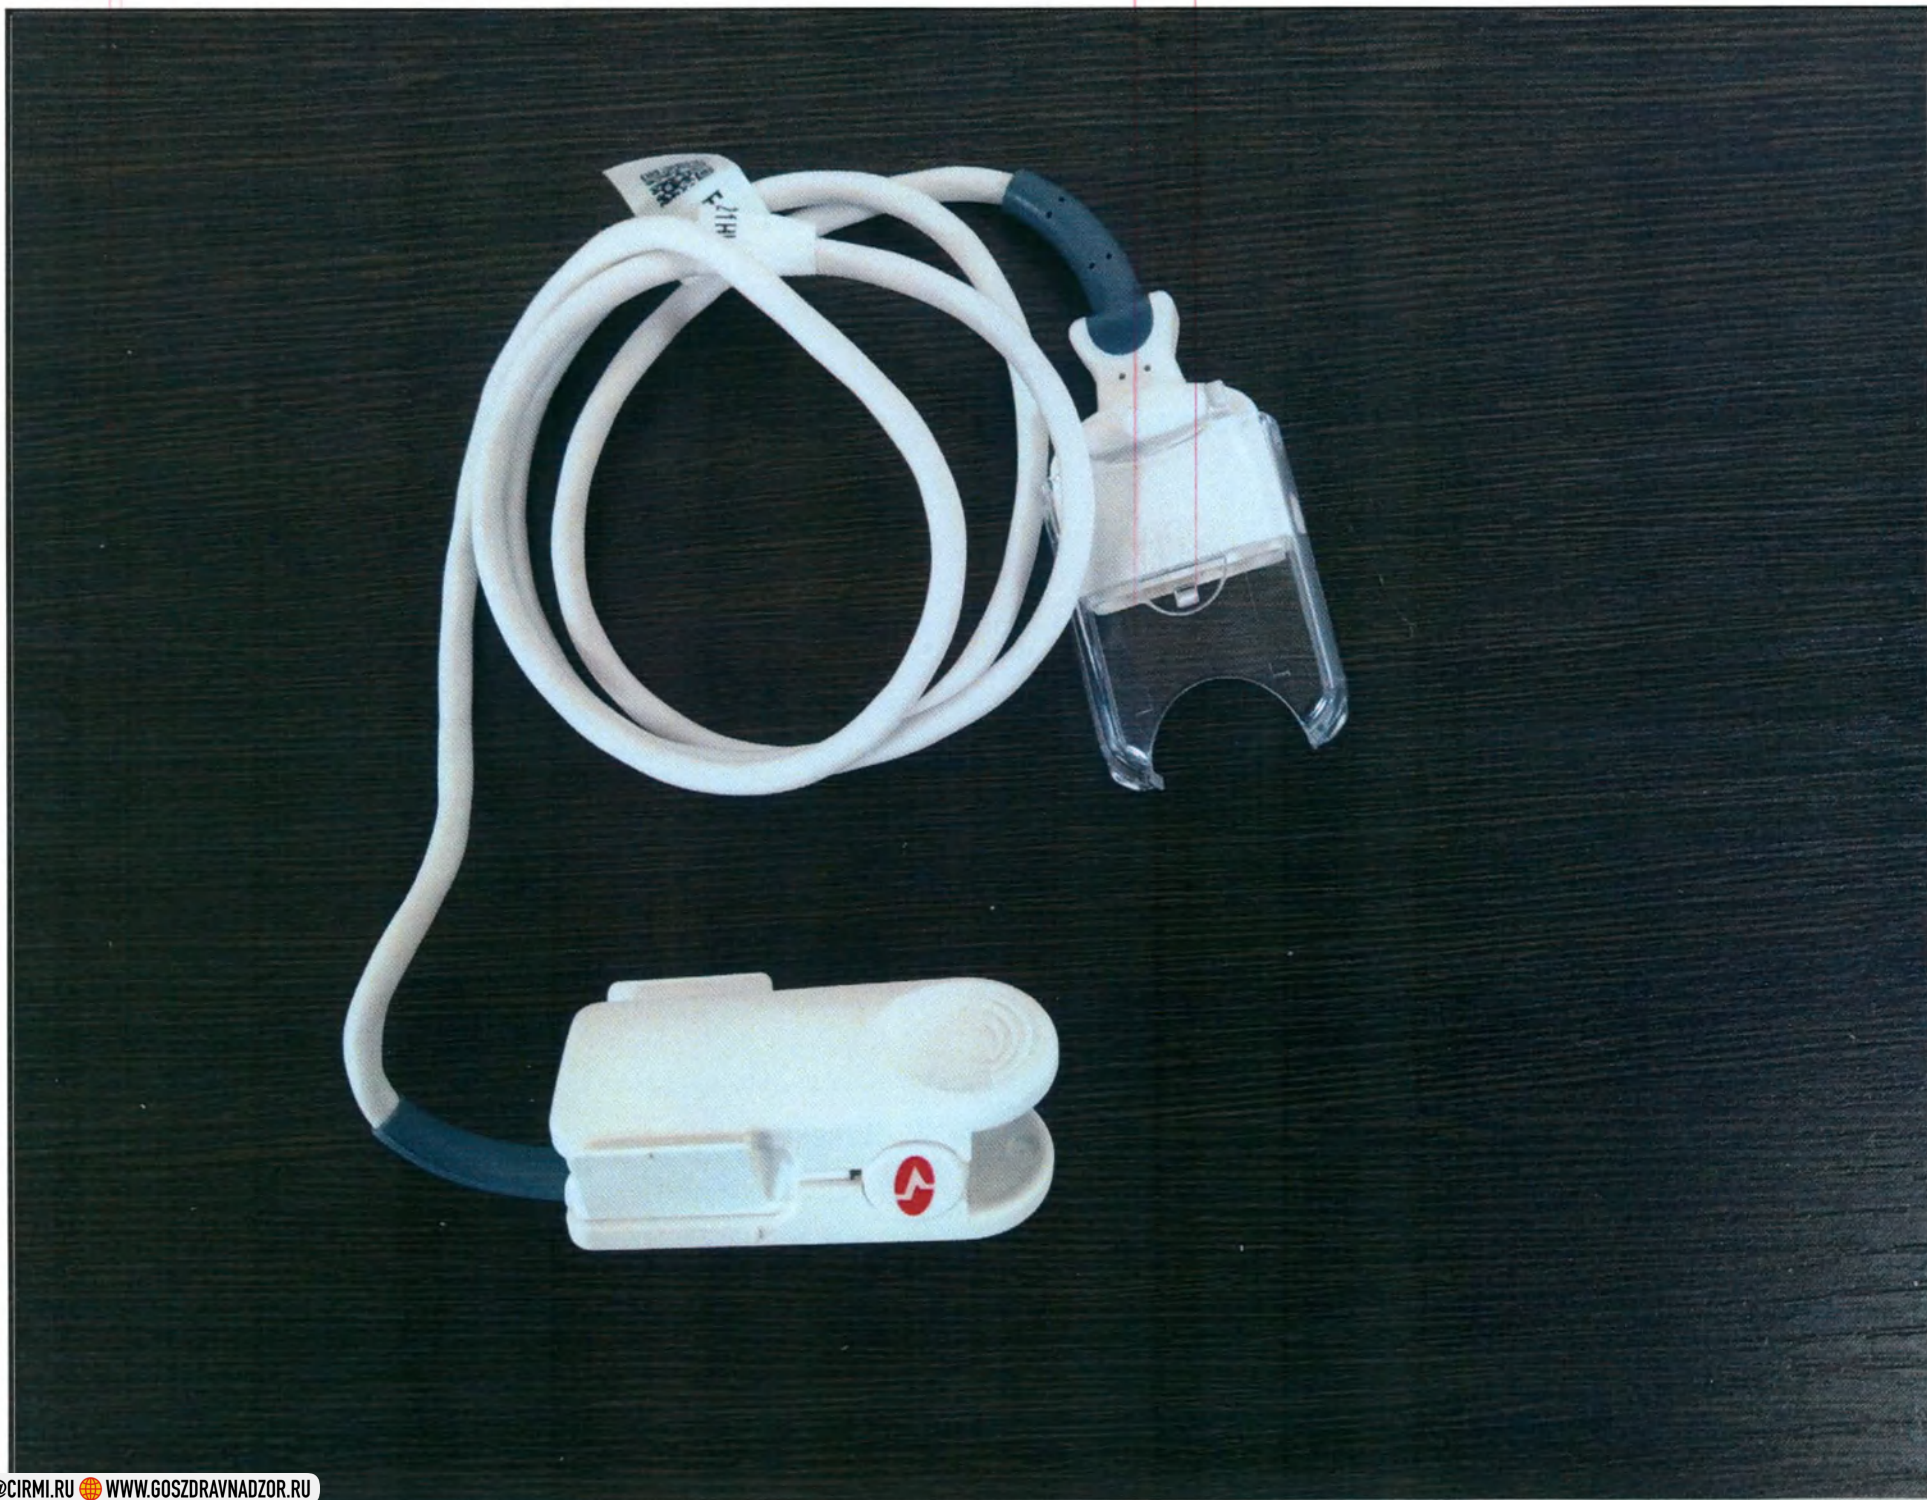




Кабель-удлиннитель AG, модель 98ME07GC968



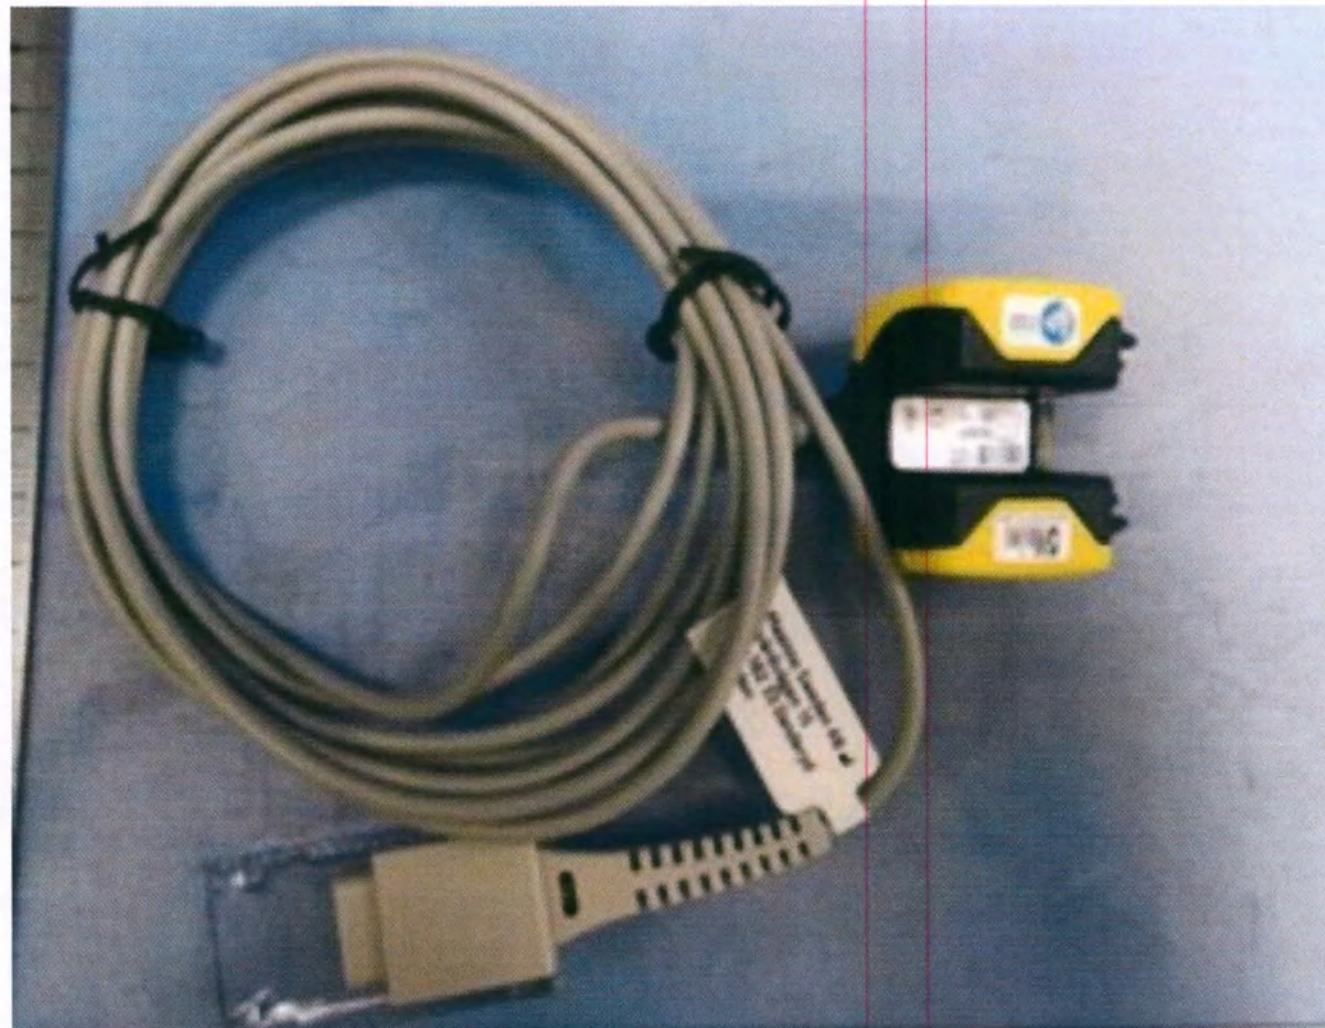


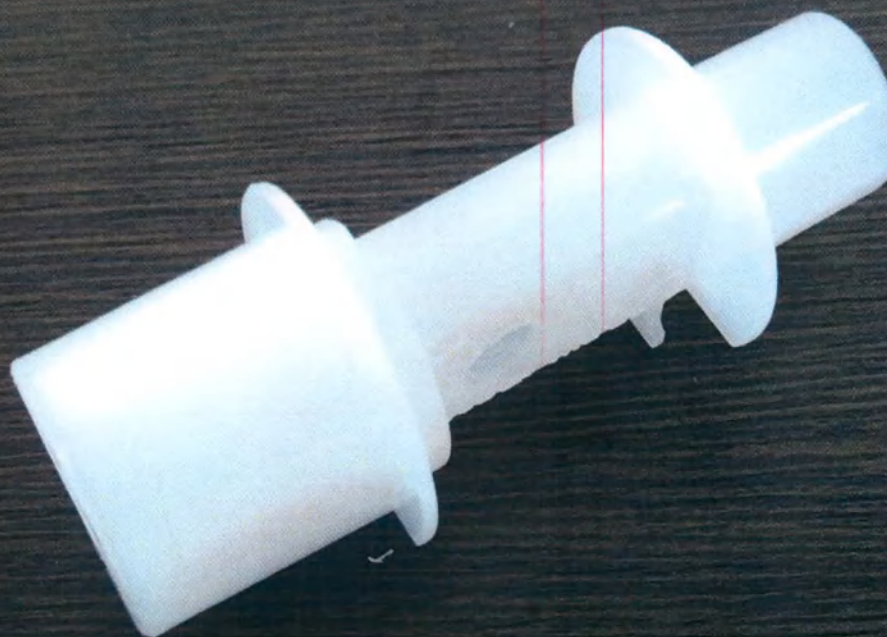





Трубка для газоанализа, «Комен» (040-00000939)

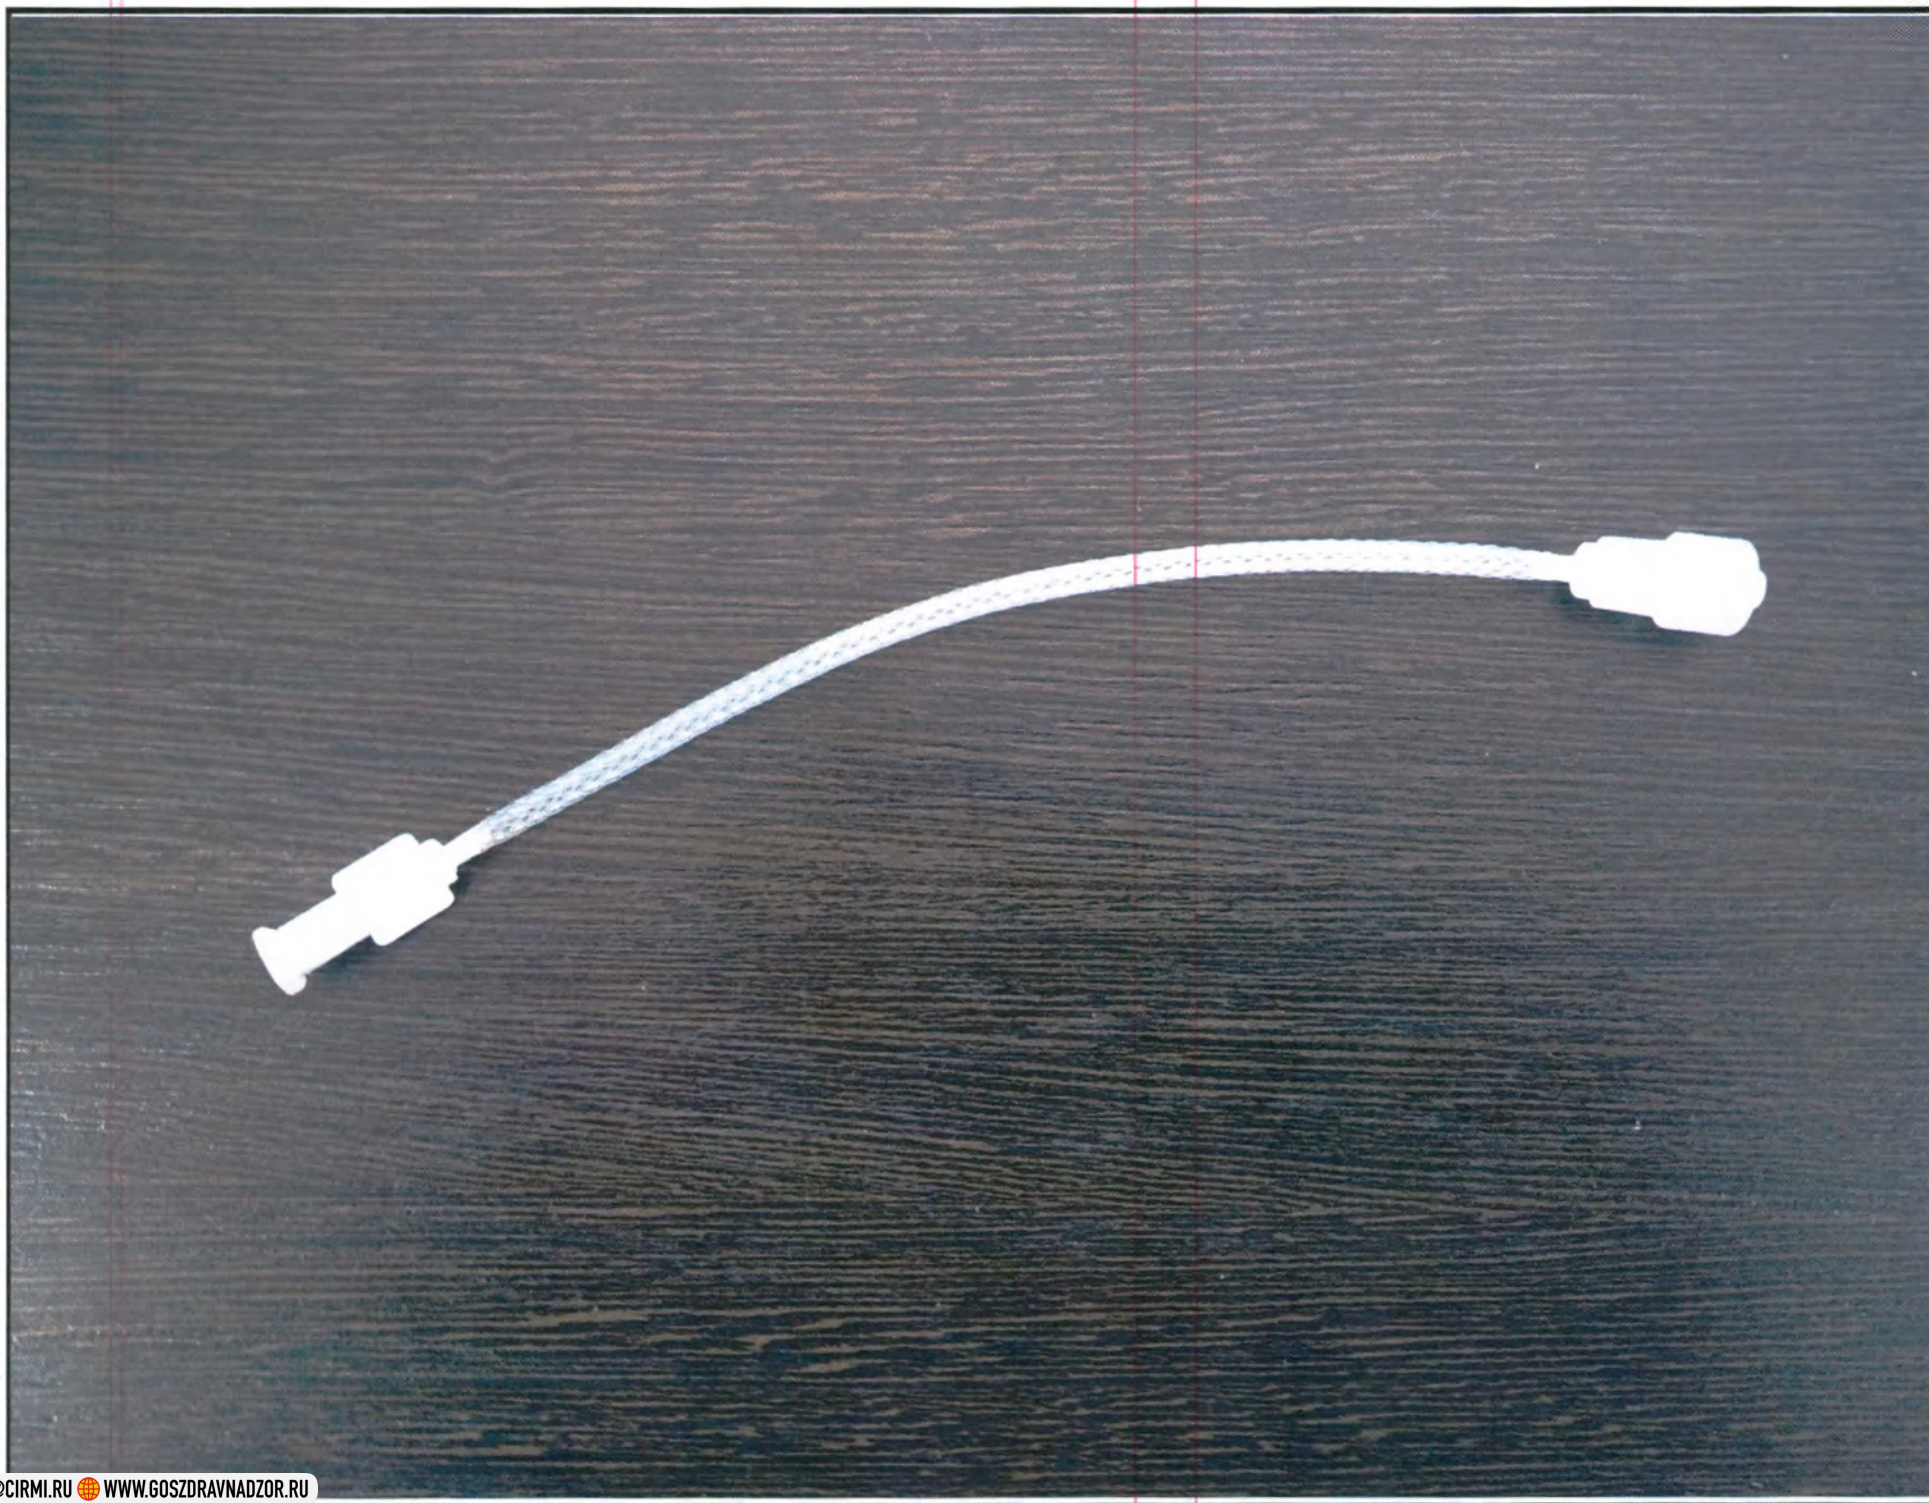

Назальная канюля для проб CO2 для новорожденных, 2,5 м (040-00001105)



Пример транспортной упаковки



ВСЕГО ПРОШИТО
И СКРЕПЛЕНО
47 ЛИСТА-ОВ-

