

Фотографии медицинского изделия:

«Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД» по ТУ 32.50.21-020-13391002-2017 в следующих вариантах исполнения:
8Ф; 8Ф-1/1; 8Ф-1/2; 8Ф-1/3; 8Ф-3; 8Ф-3В; 8Ф-5А; 8Ф-5; 8Ф-5АВ; 8Ф-8; 8Ф-10; 9Ф-3; 9Ф-3В, с принадлежностями»

производство: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД» (ООО «НПЦ МТ «АРМЕД»)

1. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф;
2. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-1/1;
3. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-1/2;
4. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-1/3;
5. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-3;
6. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-3В;
7. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-5;
8. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-5А;
9. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-8;
10. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-10;
11. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 9Ф-3;
12. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 9Ф-3В;
13. Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-5АВ;
14. Шланг кислородный, длина 3 м, диаметр 5 мм;

15. Канюля назальная, длина 5 м, диаметр 5 мм;
16. Канюля назальная детская, длина 2 м, диаметр 5 мм;
17. Диффузор;
18. Предохранитель плавкий 1 А;
19. Предохранитель плавкий 5 А;
20. Фильтр тонкой очистки;
21. Фильтр губчатый;
22. Пульт ДУ:
- 22.1 Пульт ДУ (для варианта исполнения 8Ф-1/1, 8Ф-1/2, 8Ф-1/3);
- 22.2 Пульт ДУ (для варианта исполнения 8Ф-5АВ);
23. Шланг Ø10мм длиной 170 мм;
24. Ключ для фиксации панели управления концентратора;
25. Увлажнитель;
26. Комплект для ингаляций;
27. Руководство по эксплуатации.

ный директор

ь)

(подпись и печать)

(А.А.Щукарев)

(И.О.Фамилия)

и Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД» (ООО «НПЦ МТ
»)

(наименование организации-заявителя)



Рис. 1 – Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф;

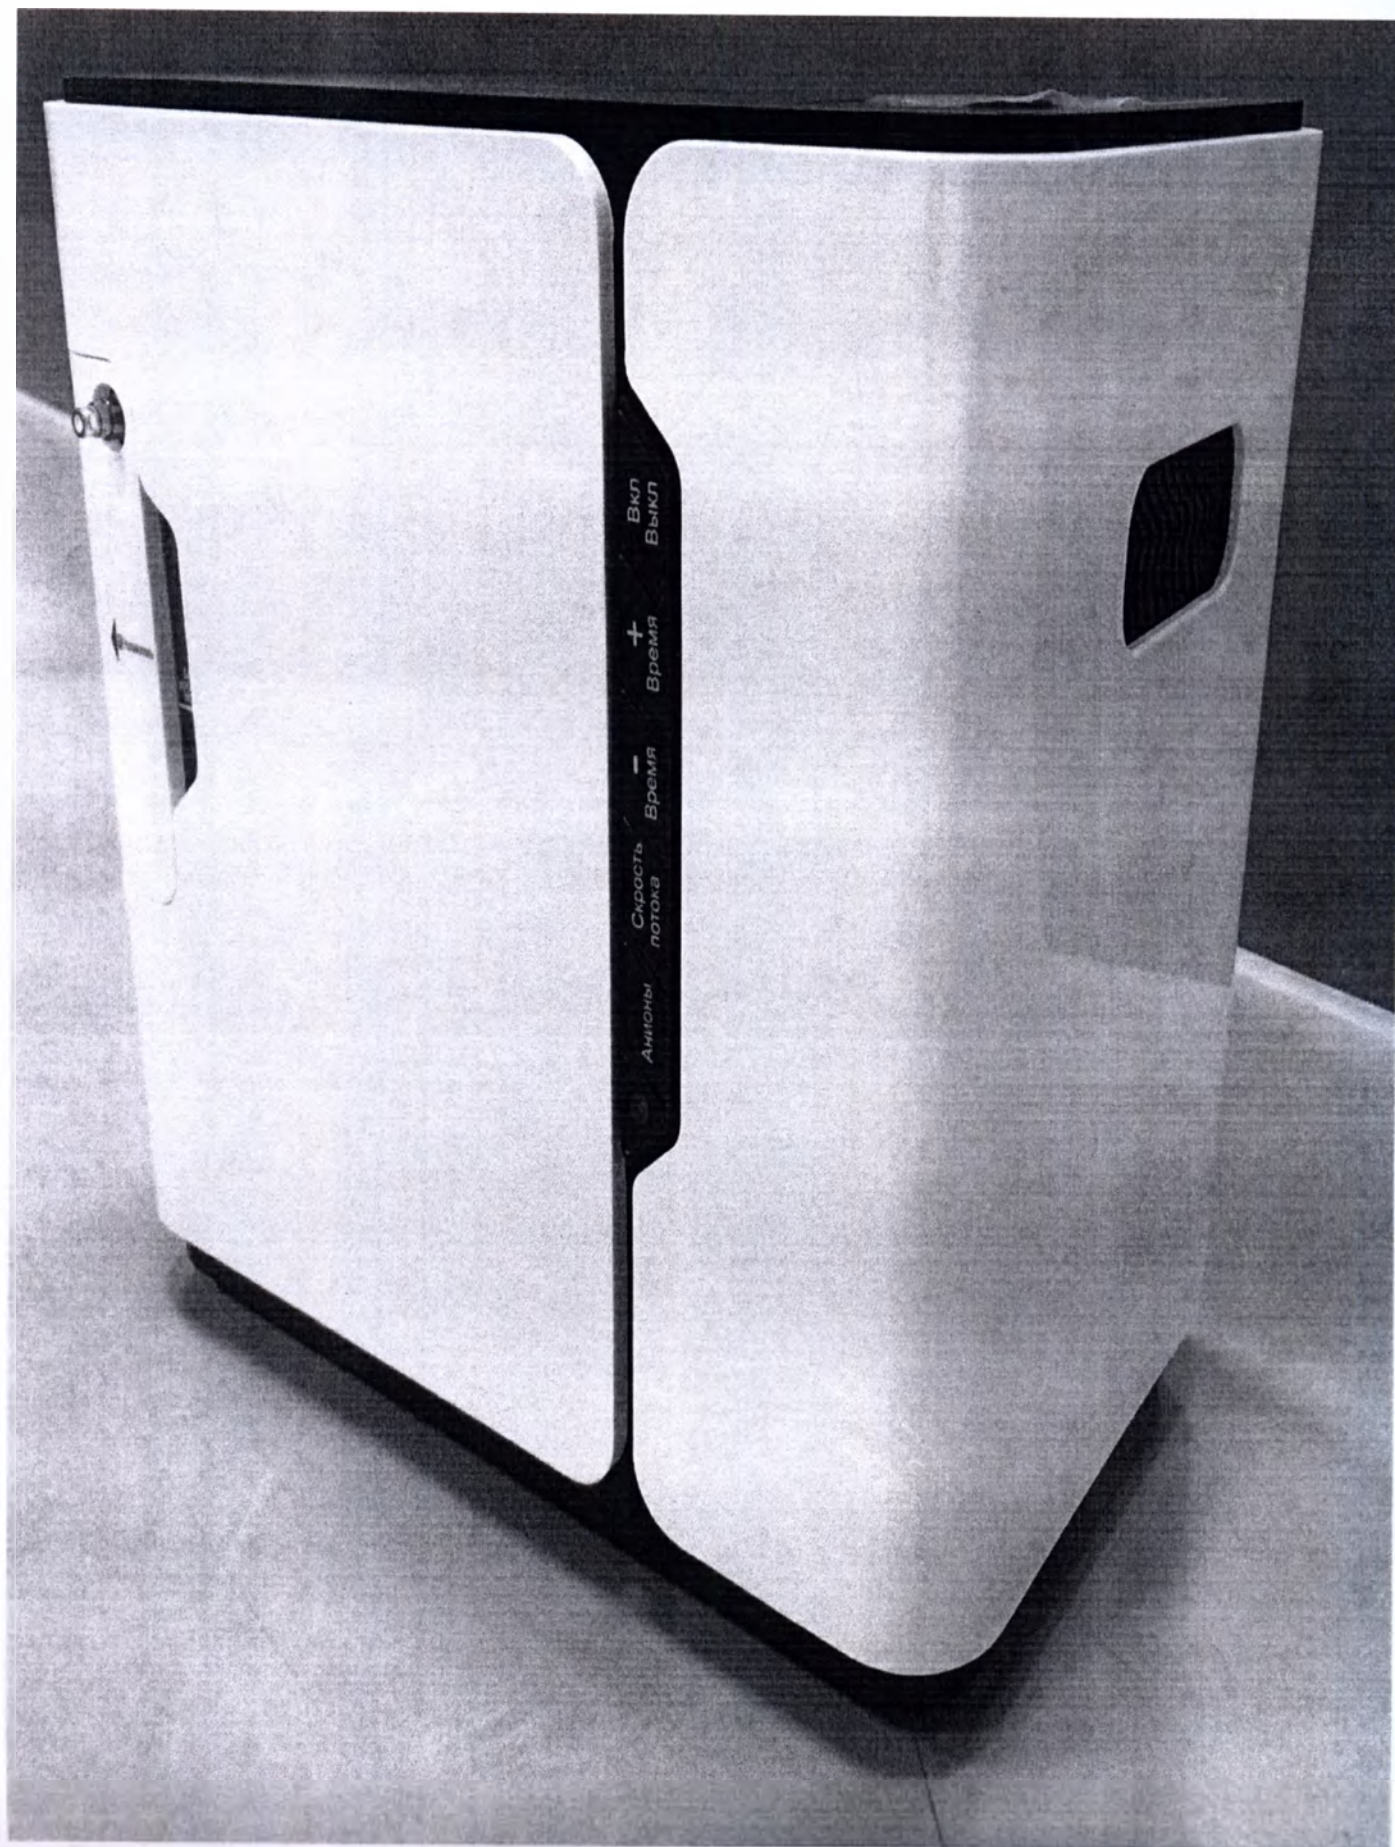


Рис. 2 -Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-1/1;



Рис. 3 - Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-1/2;



Рис. 4 - Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-1/3;



Рис. 5 - Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-3;



Рис. 6 - Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-3В;



Рис. 7 - Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-5;

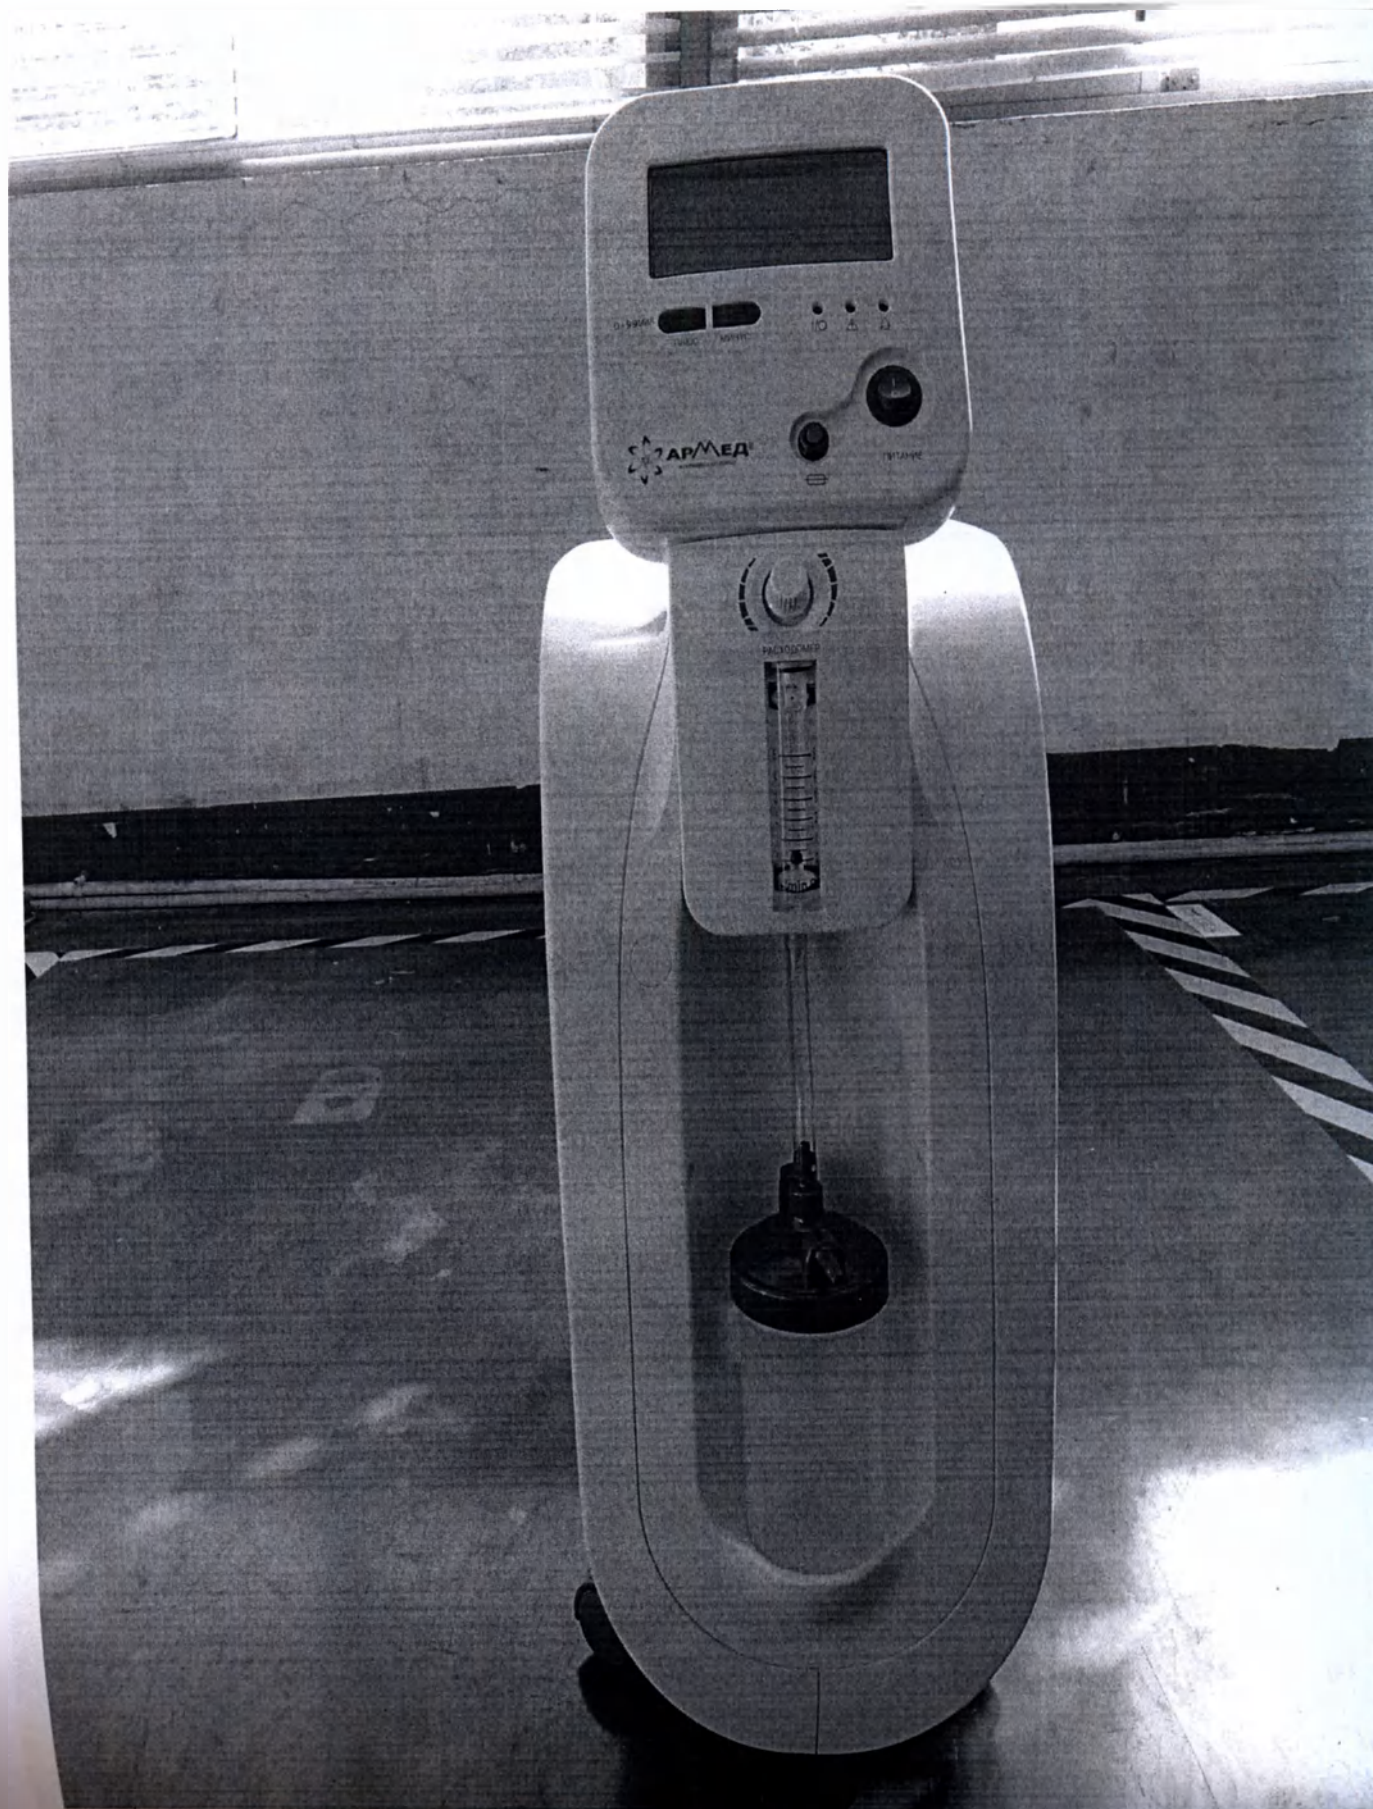


Рис. 8 - Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-5А;

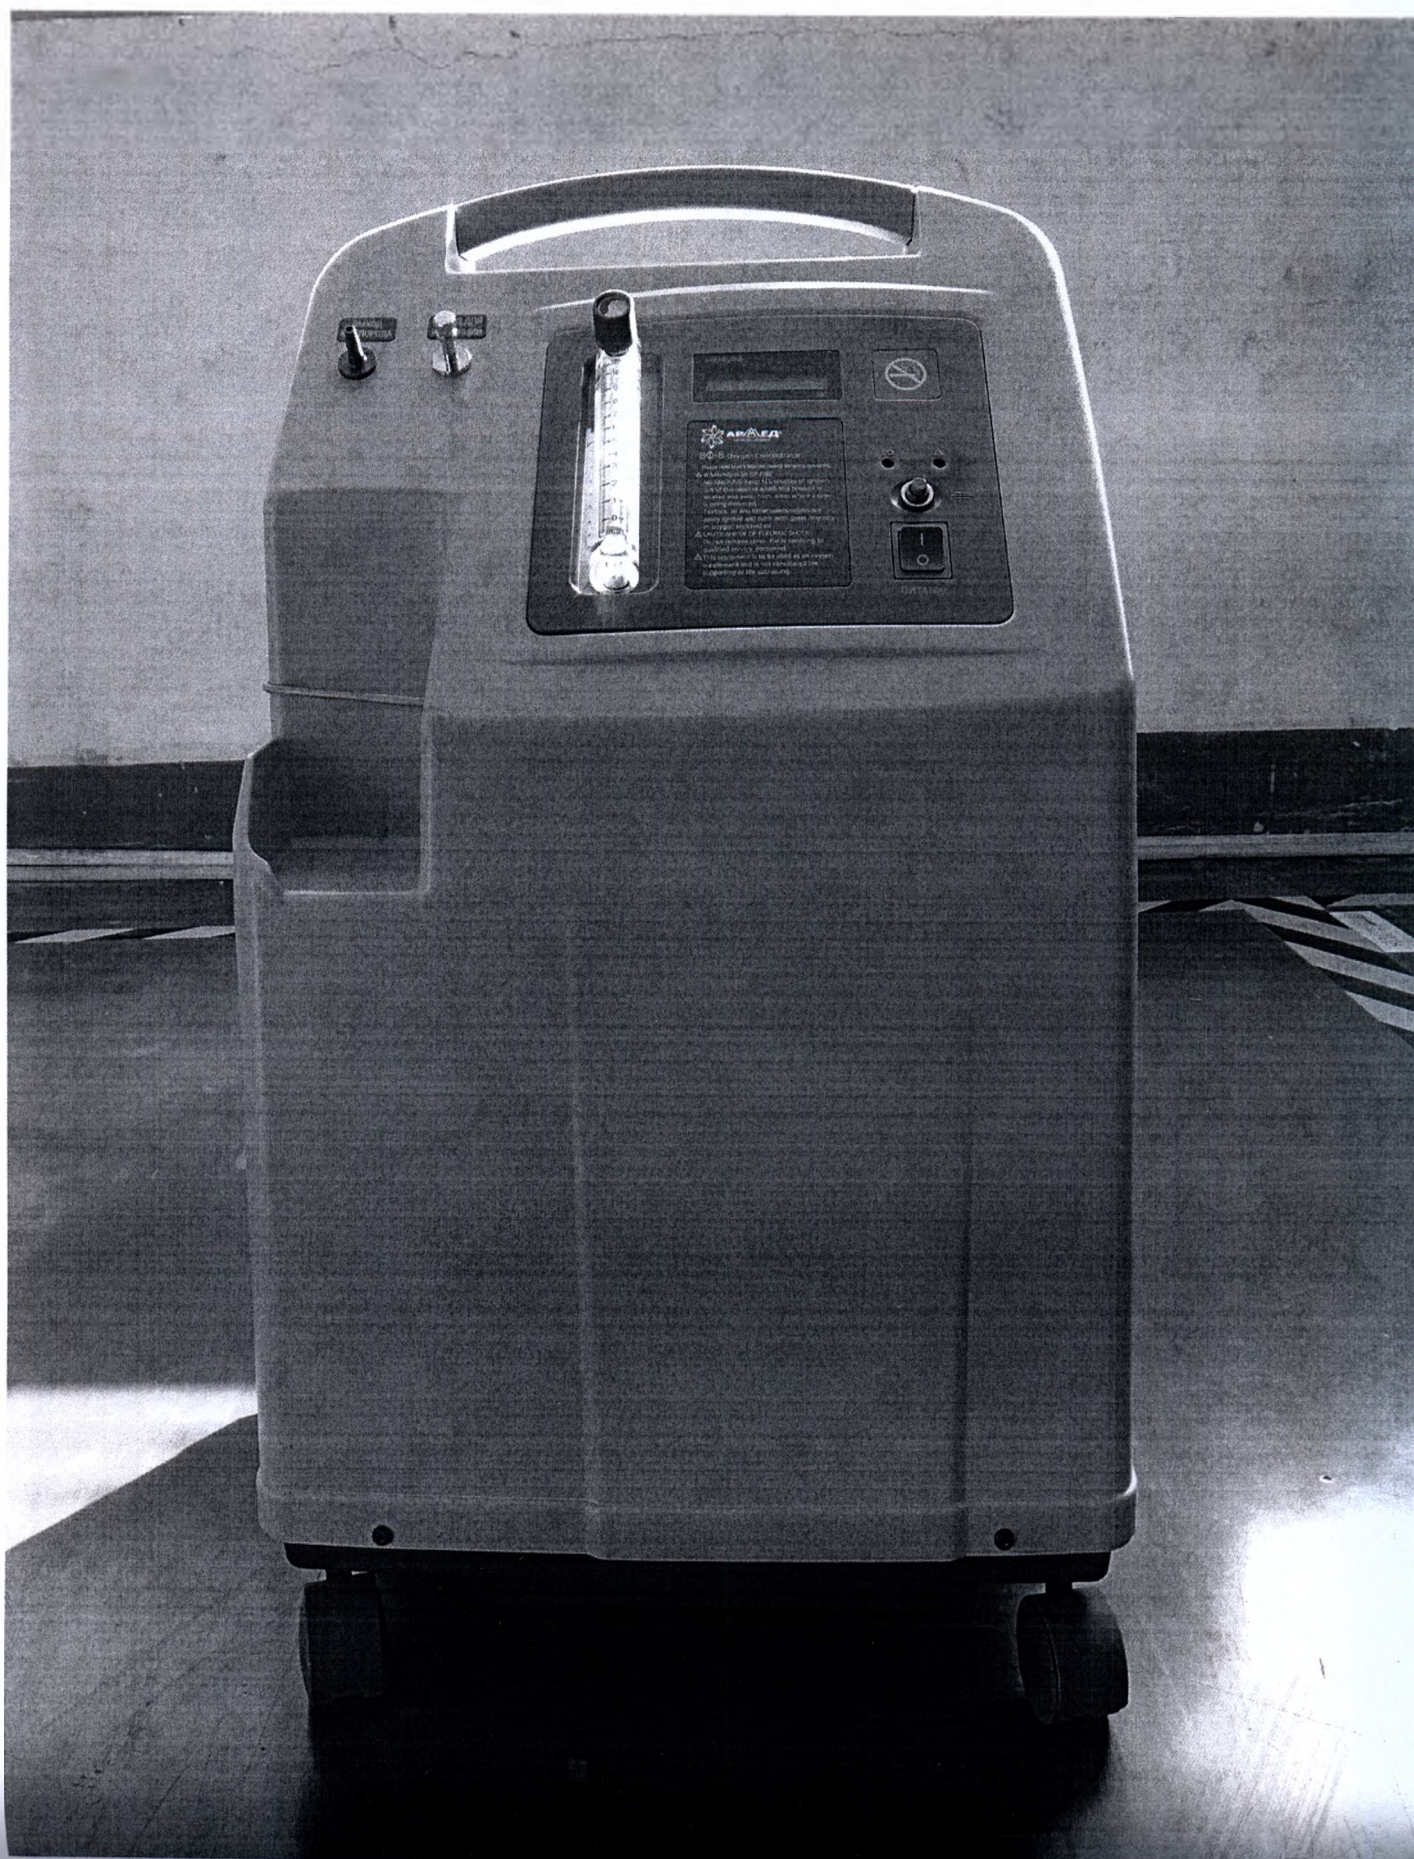


Рис. 9 - Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-8;

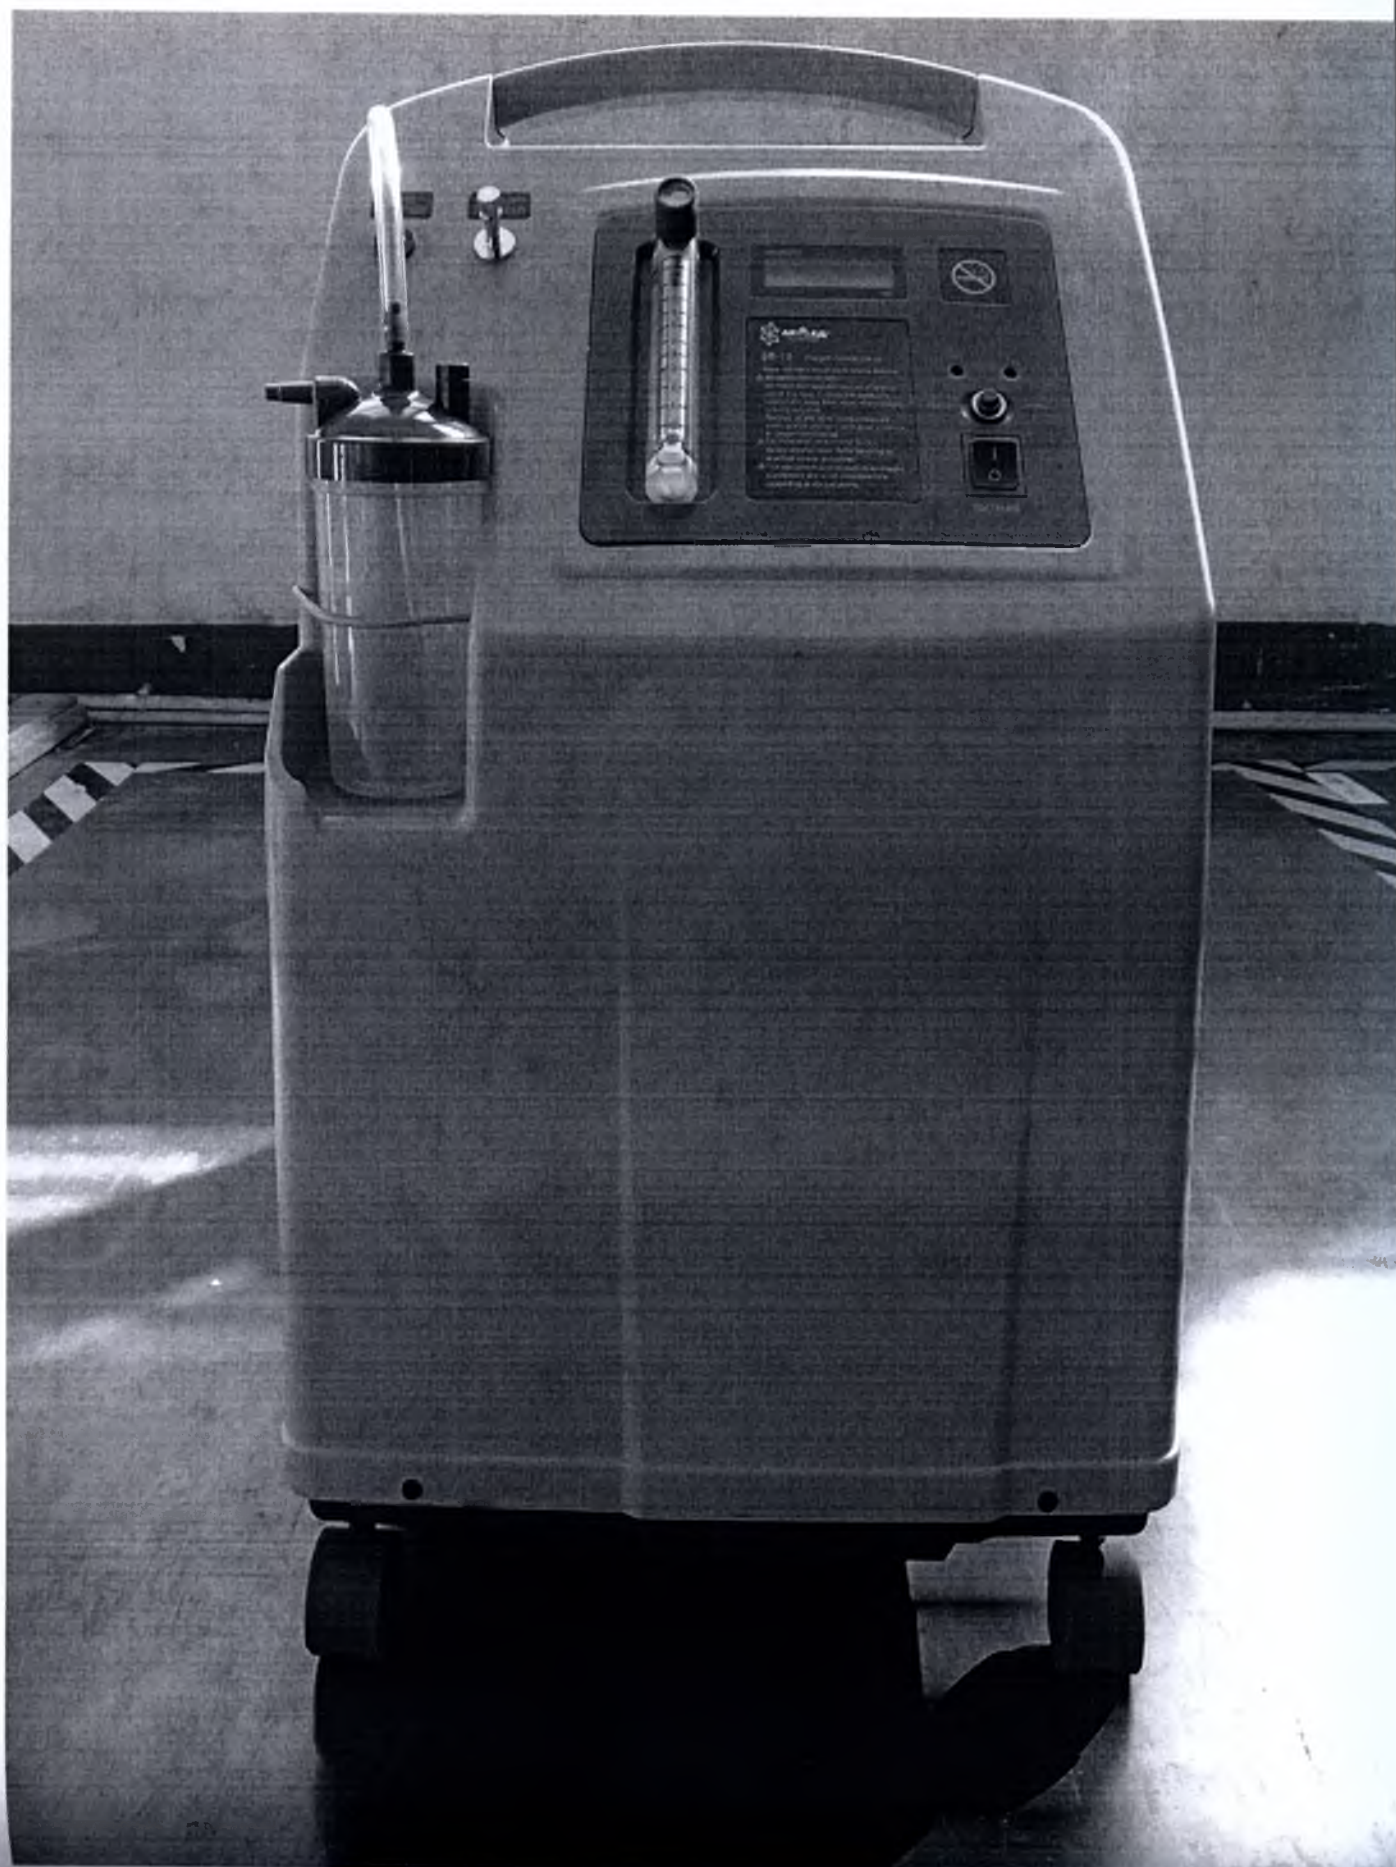


Рис. 10 - Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-10;

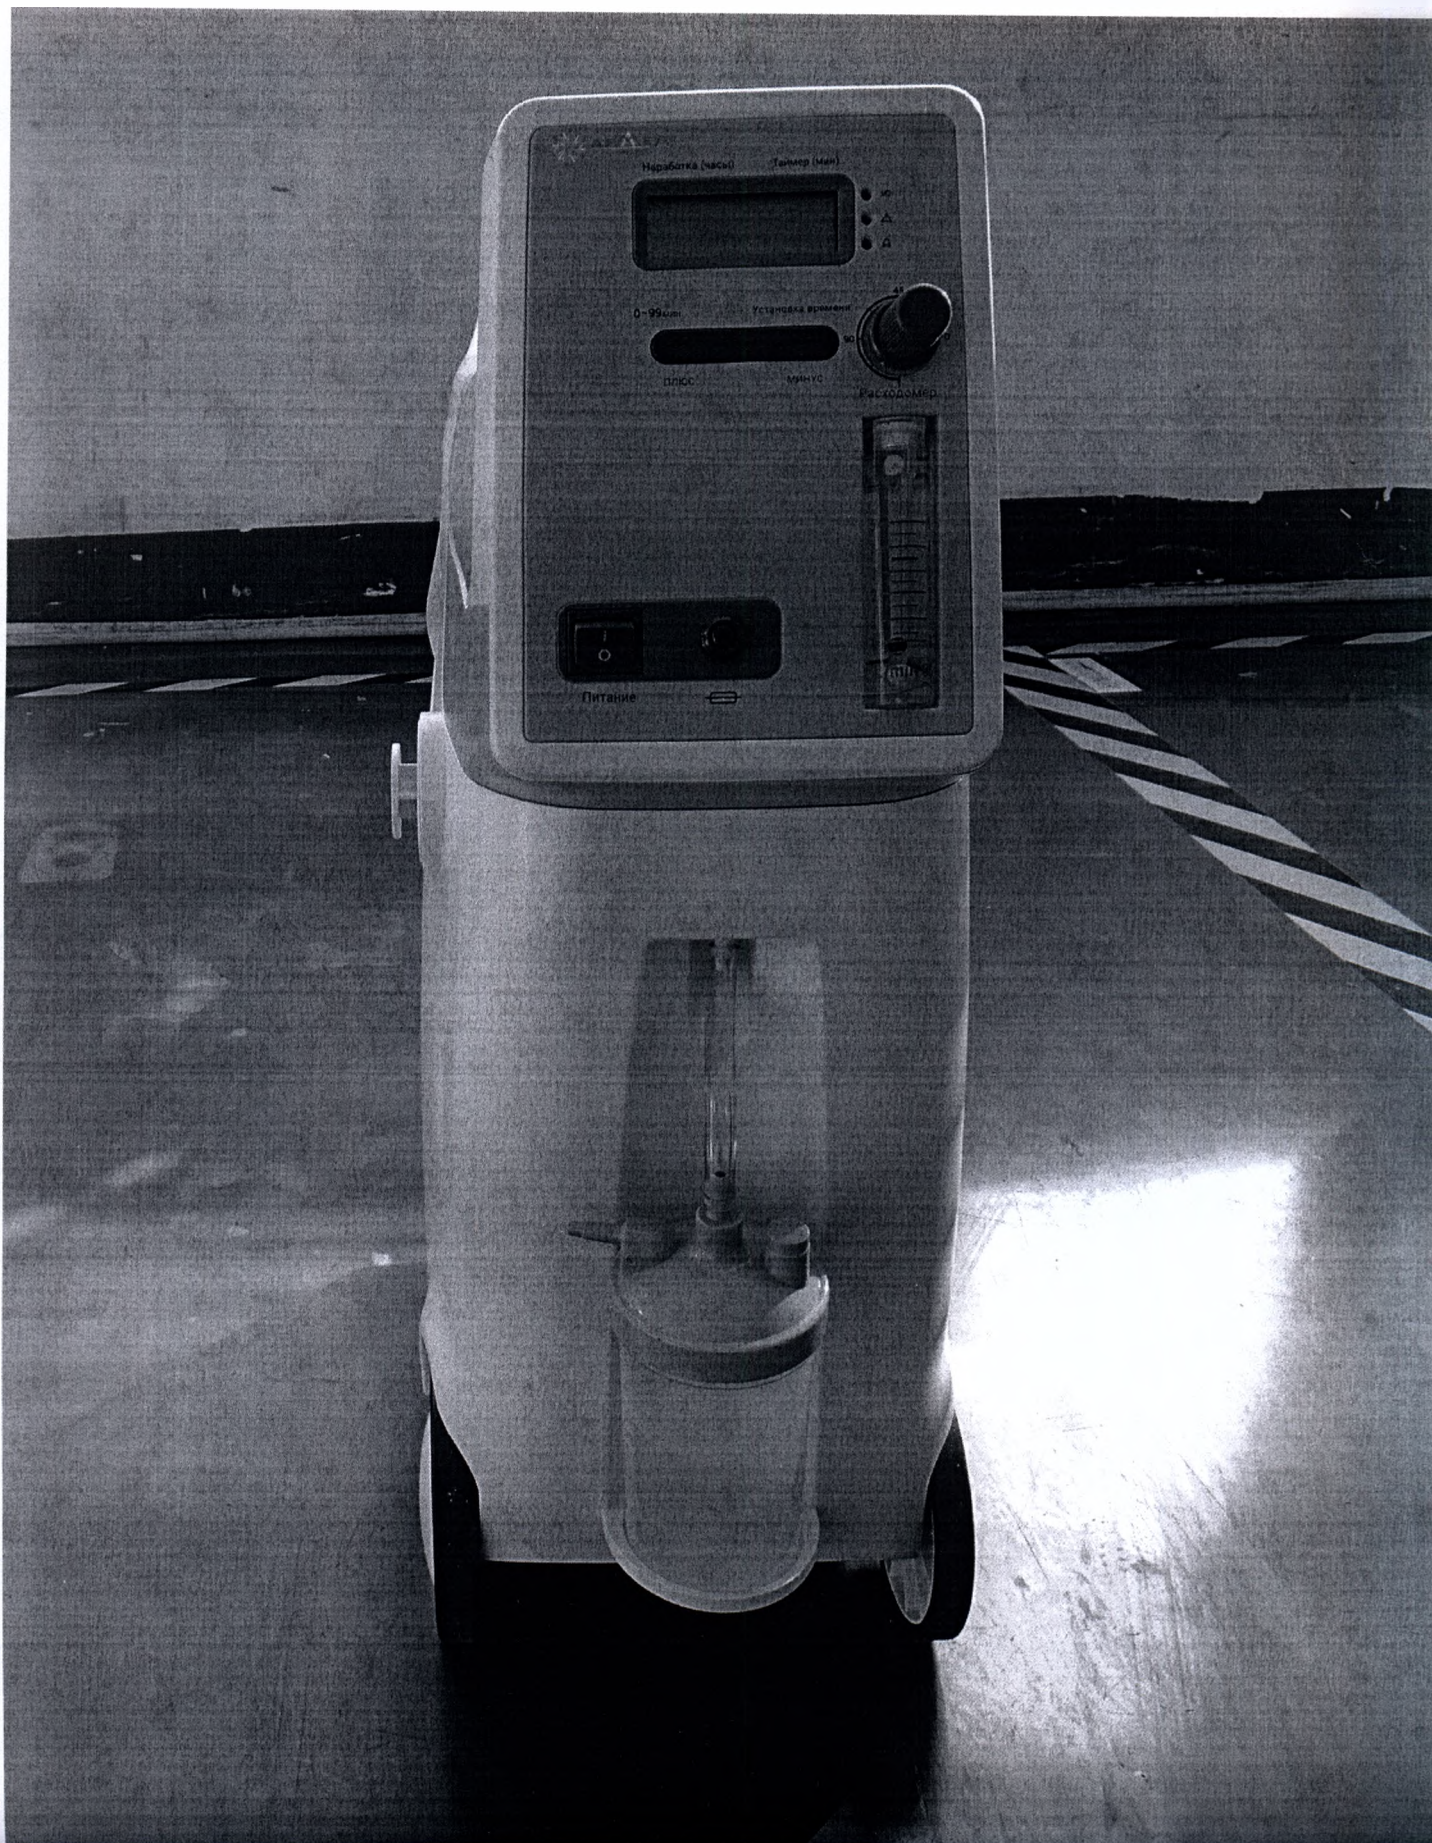


Рис. 11 - Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 9Ф-3;

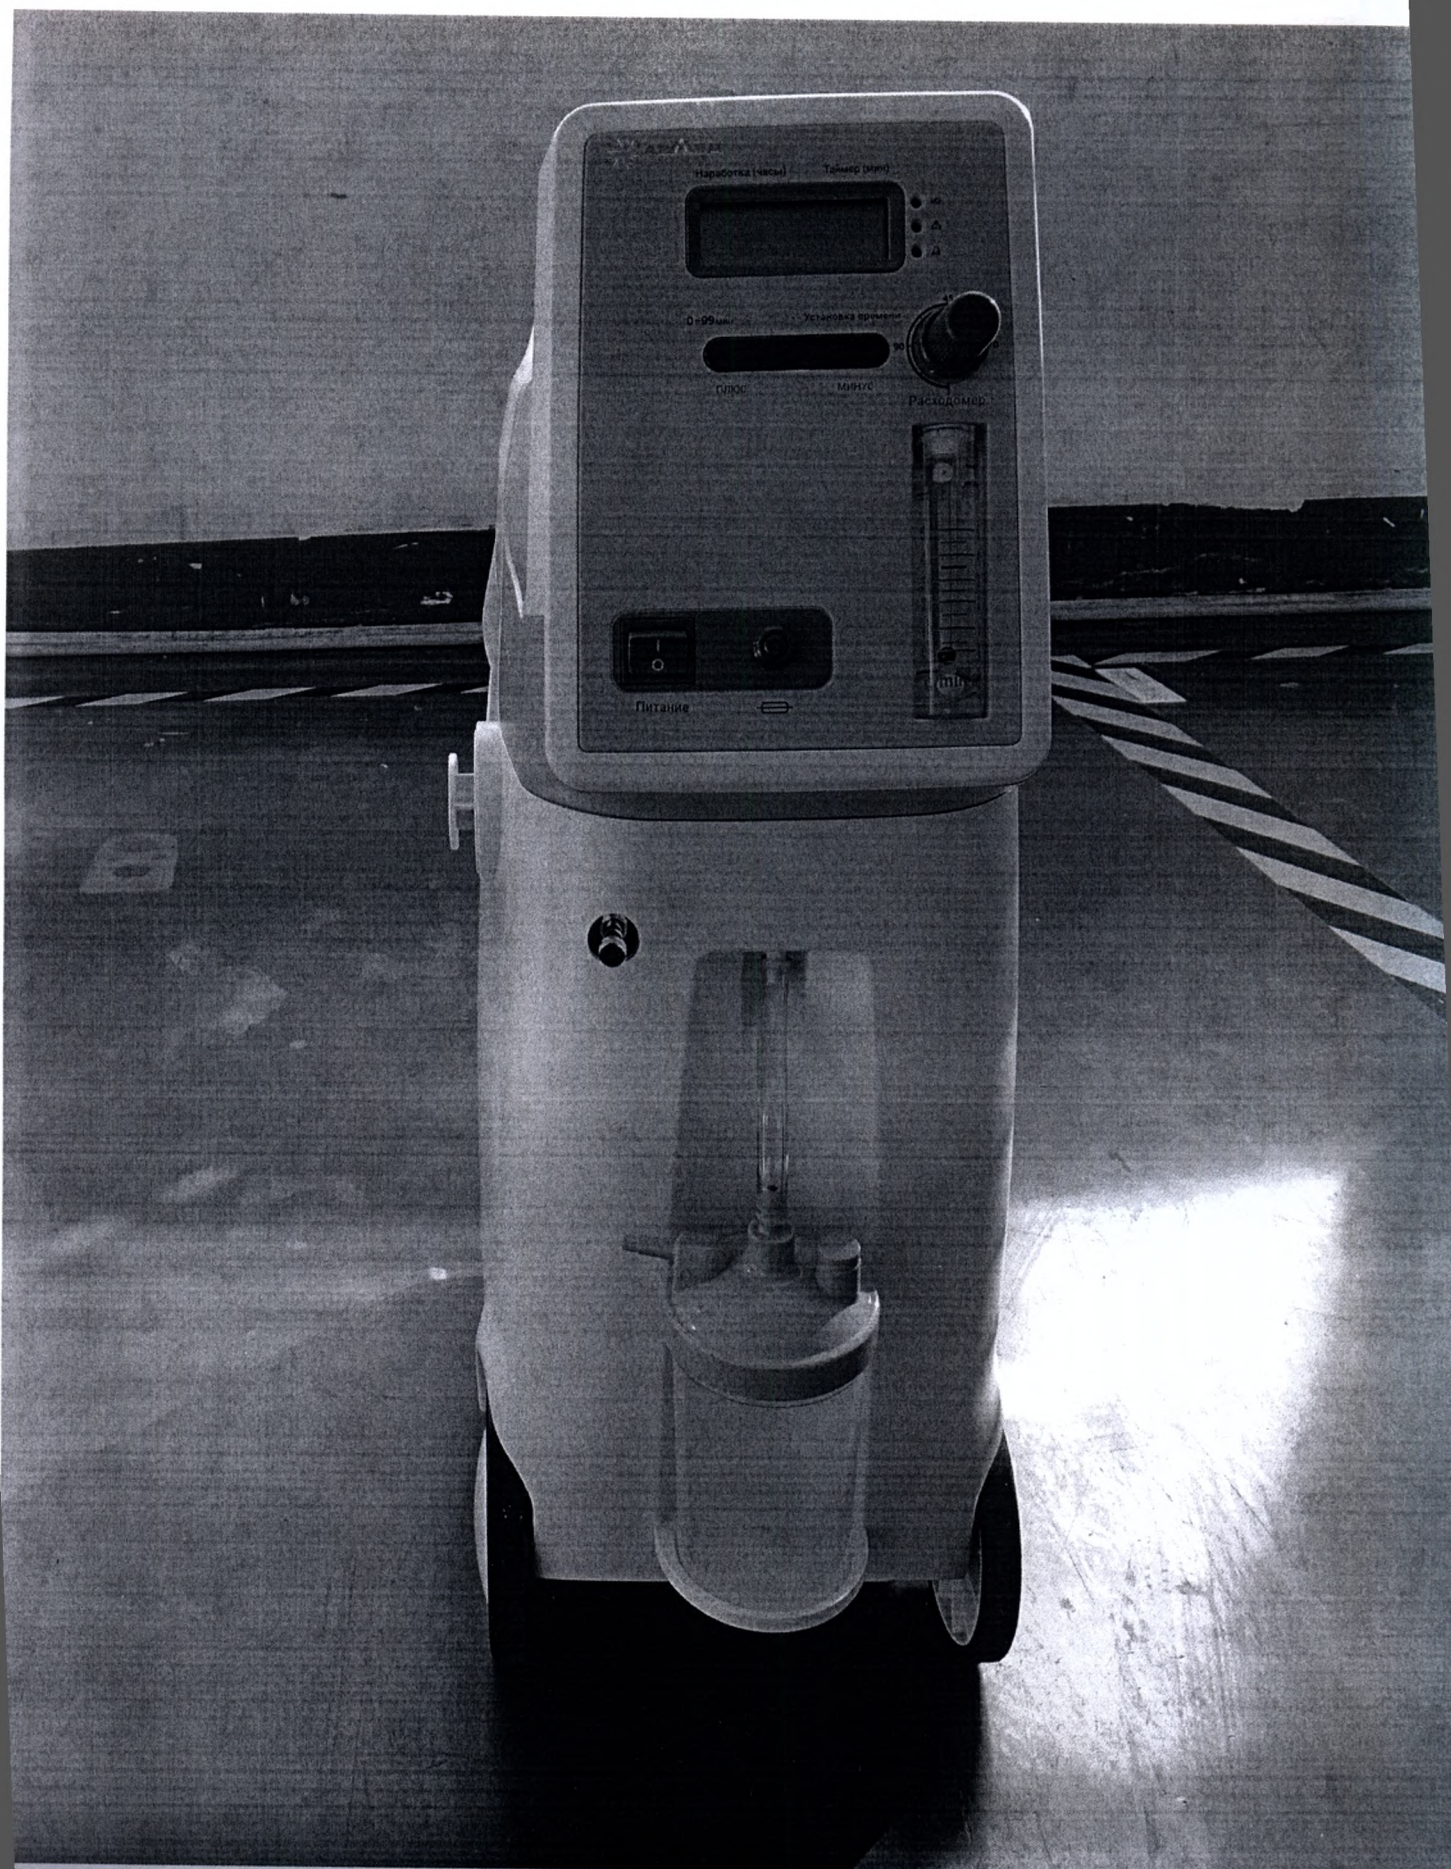


Рис. 12 - Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 9Ф-3В;

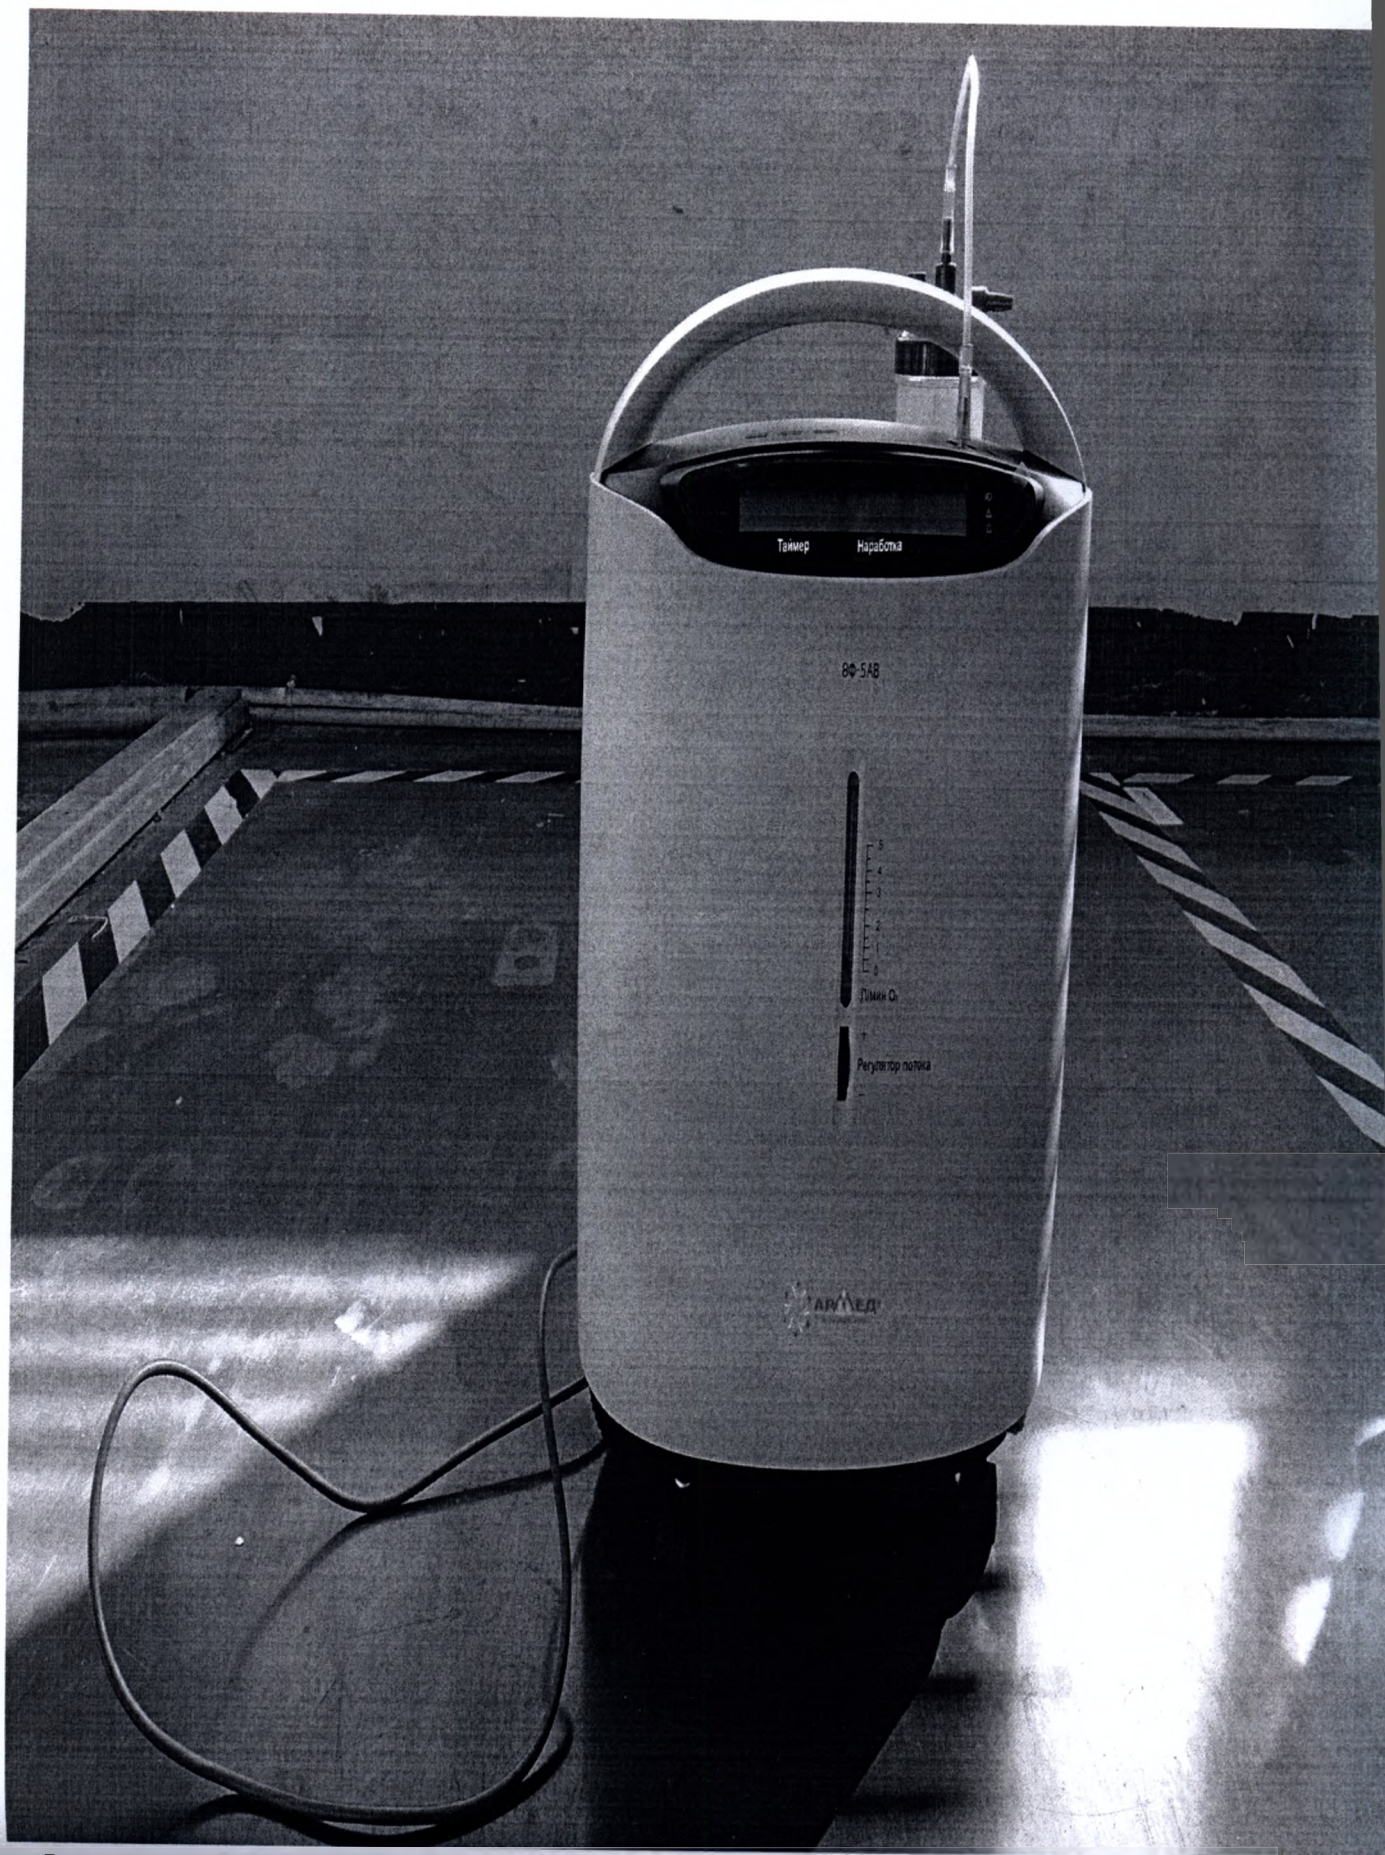


Рис. 13 - Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД», вариант исполнения 8Ф-5АВ;

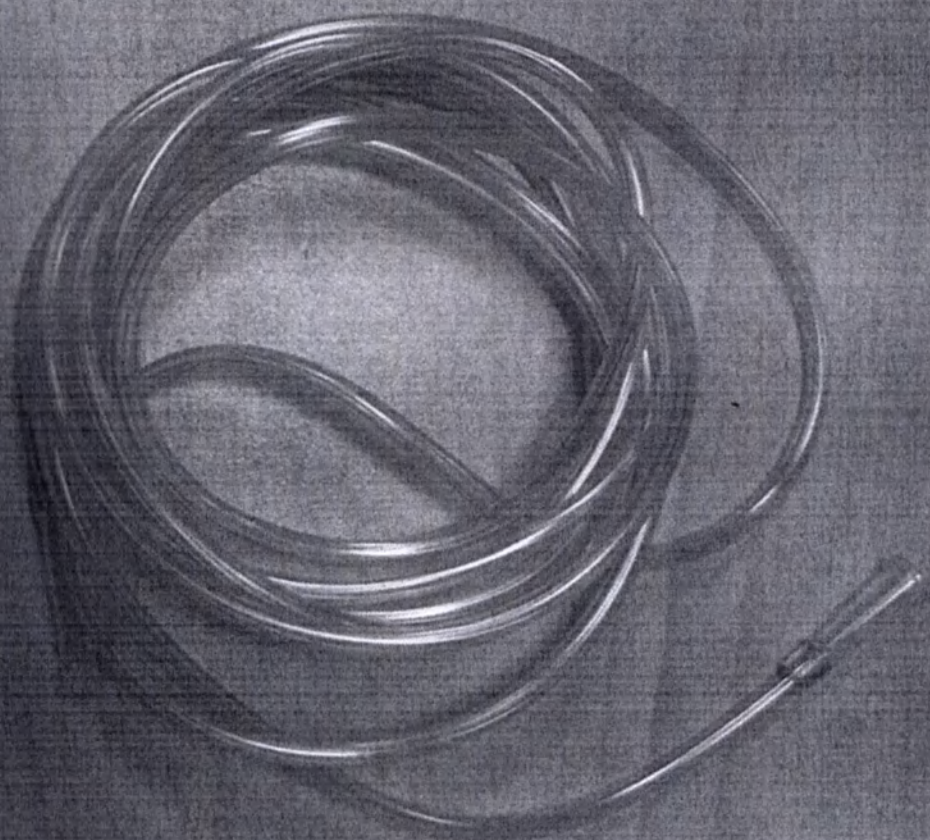


Рис. 14 - Шланг кислородный, длина 3 м, диаметр 5 мм;

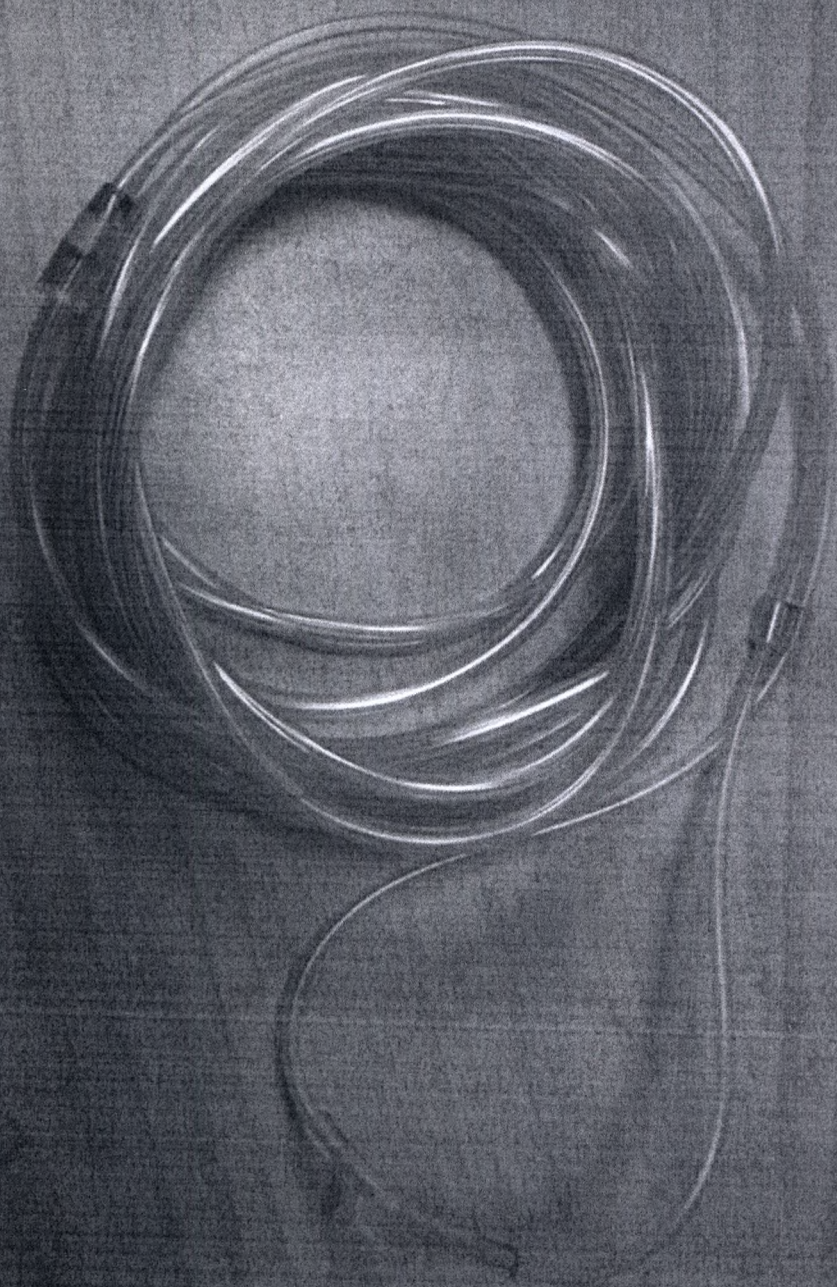


Рис. 15 - Канюля назальная, длина 5 м, диаметр 5 мм;



Рис. 16 - Канюля назальная детская, длина 2 м, диаметр 5 мм;



Рис. 17 - Диффузор;

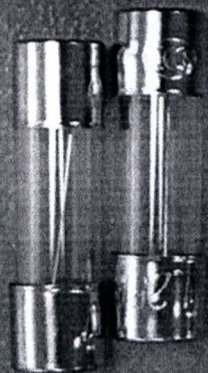


Рис. 18 - Предохранитель плавкий 1 А;



Рис. 19 - Предохранитель плавкий 5 А;



Рис. 20 - Фильтр тонкой очистки;



Рис. 21 - Фильтр губчатый;



Рис. 22.1 Пульт ДУ (для варианта исполнения 8Ф-1/1, 8Ф-1/2, 8Ф-1/3);

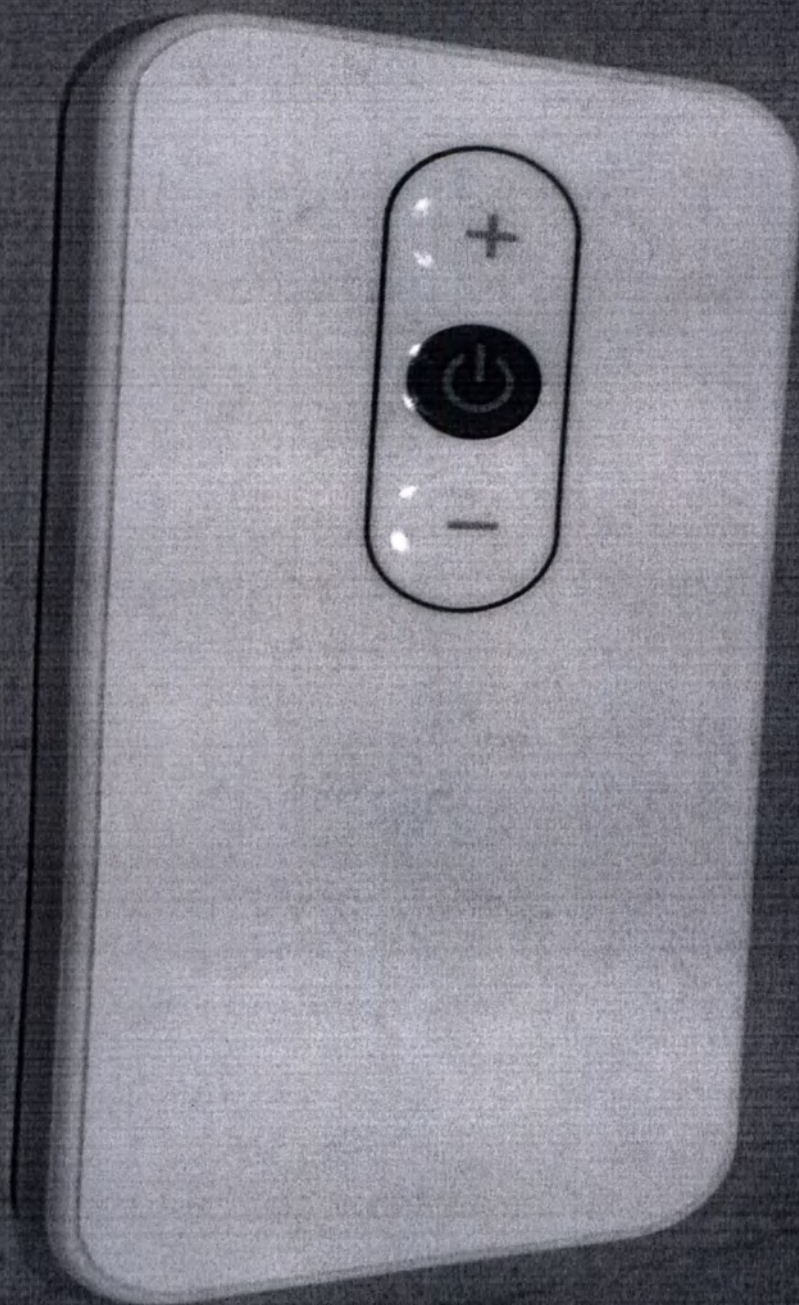


Рис. 22.2 - Пульт ДУ (для варианта исполнения 8Ф-5АВ);

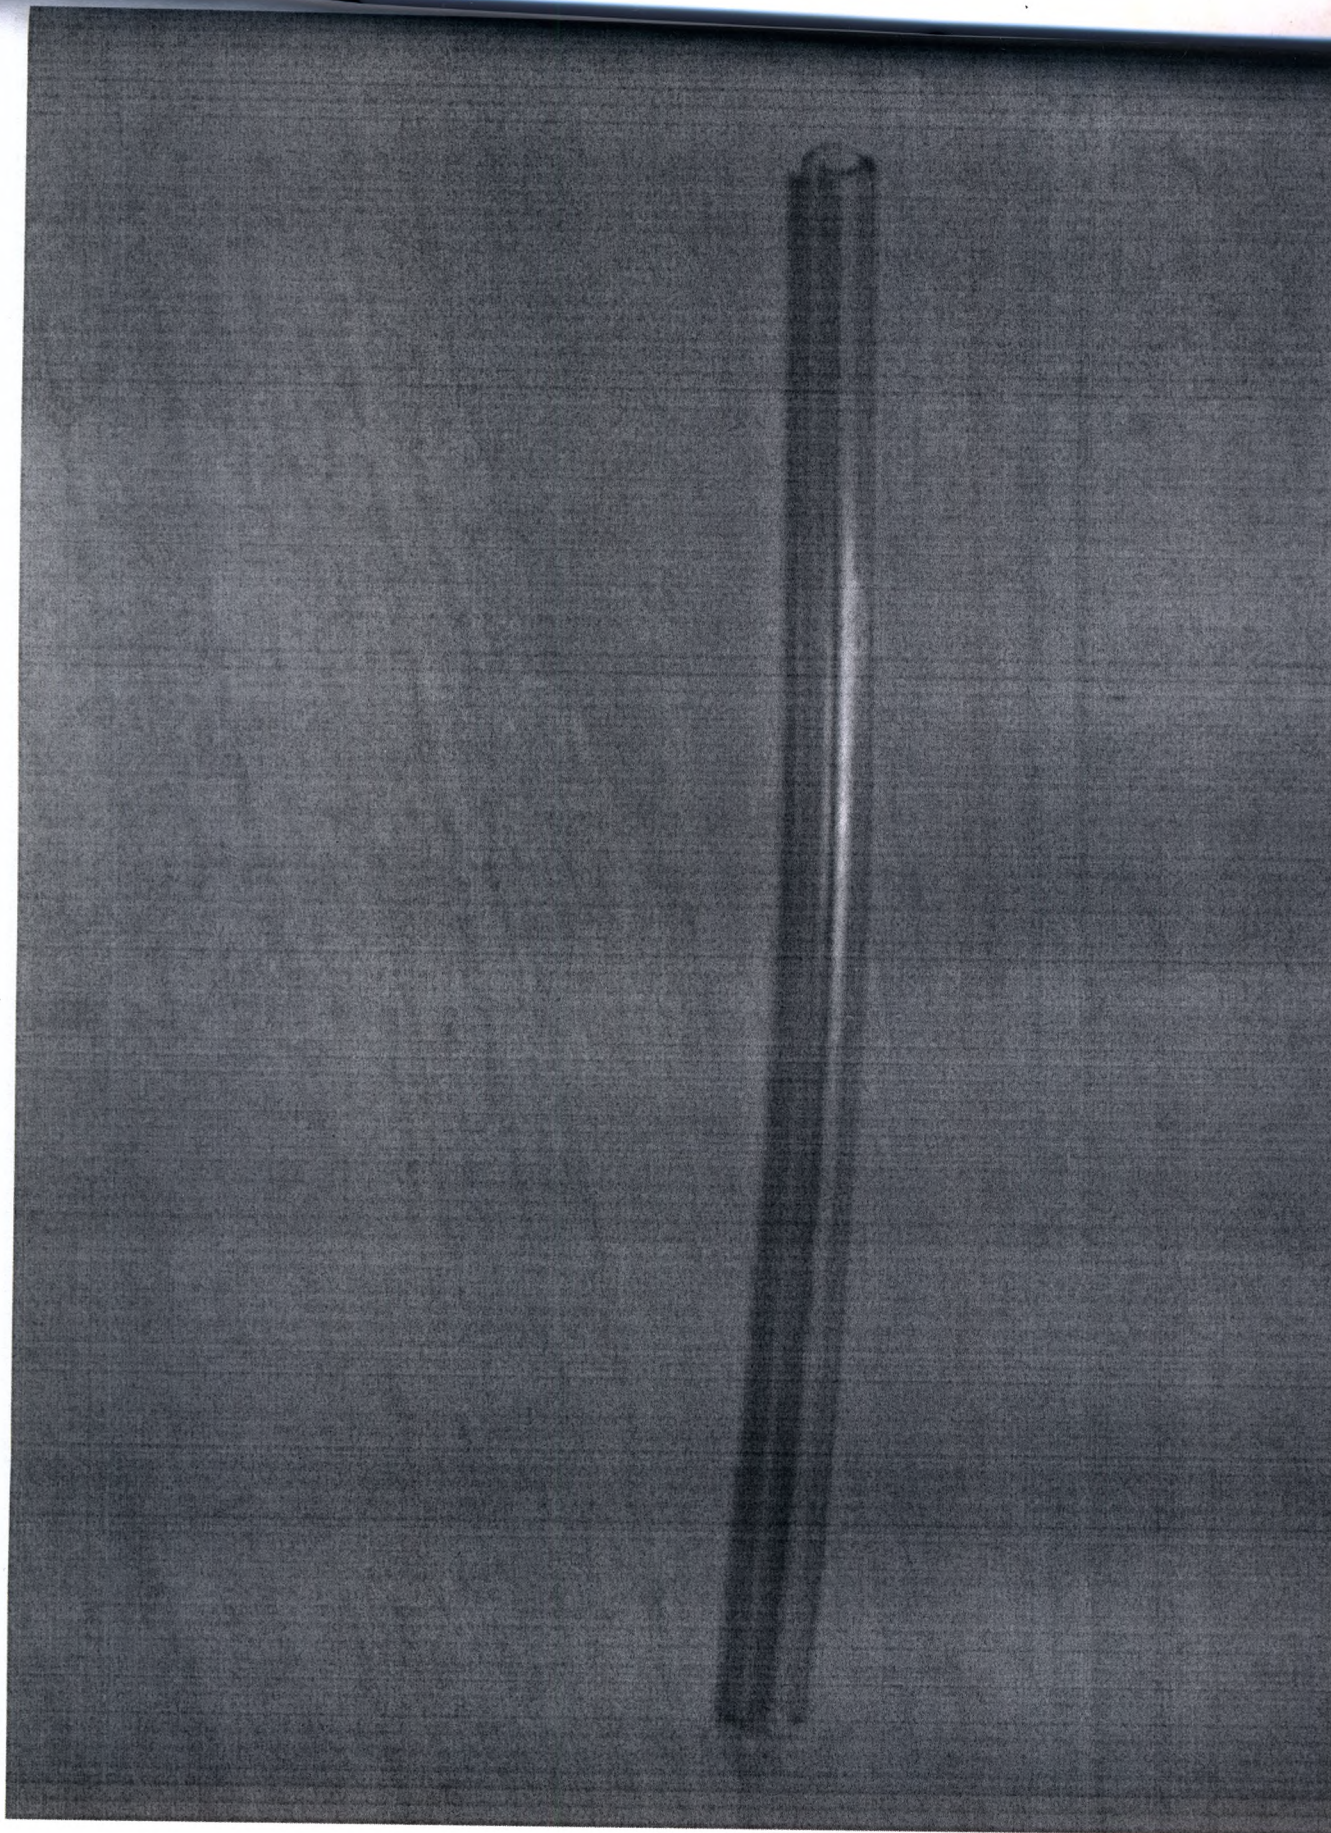


Рис. 23 - Шланг Ø10мм длиной 170 мм;

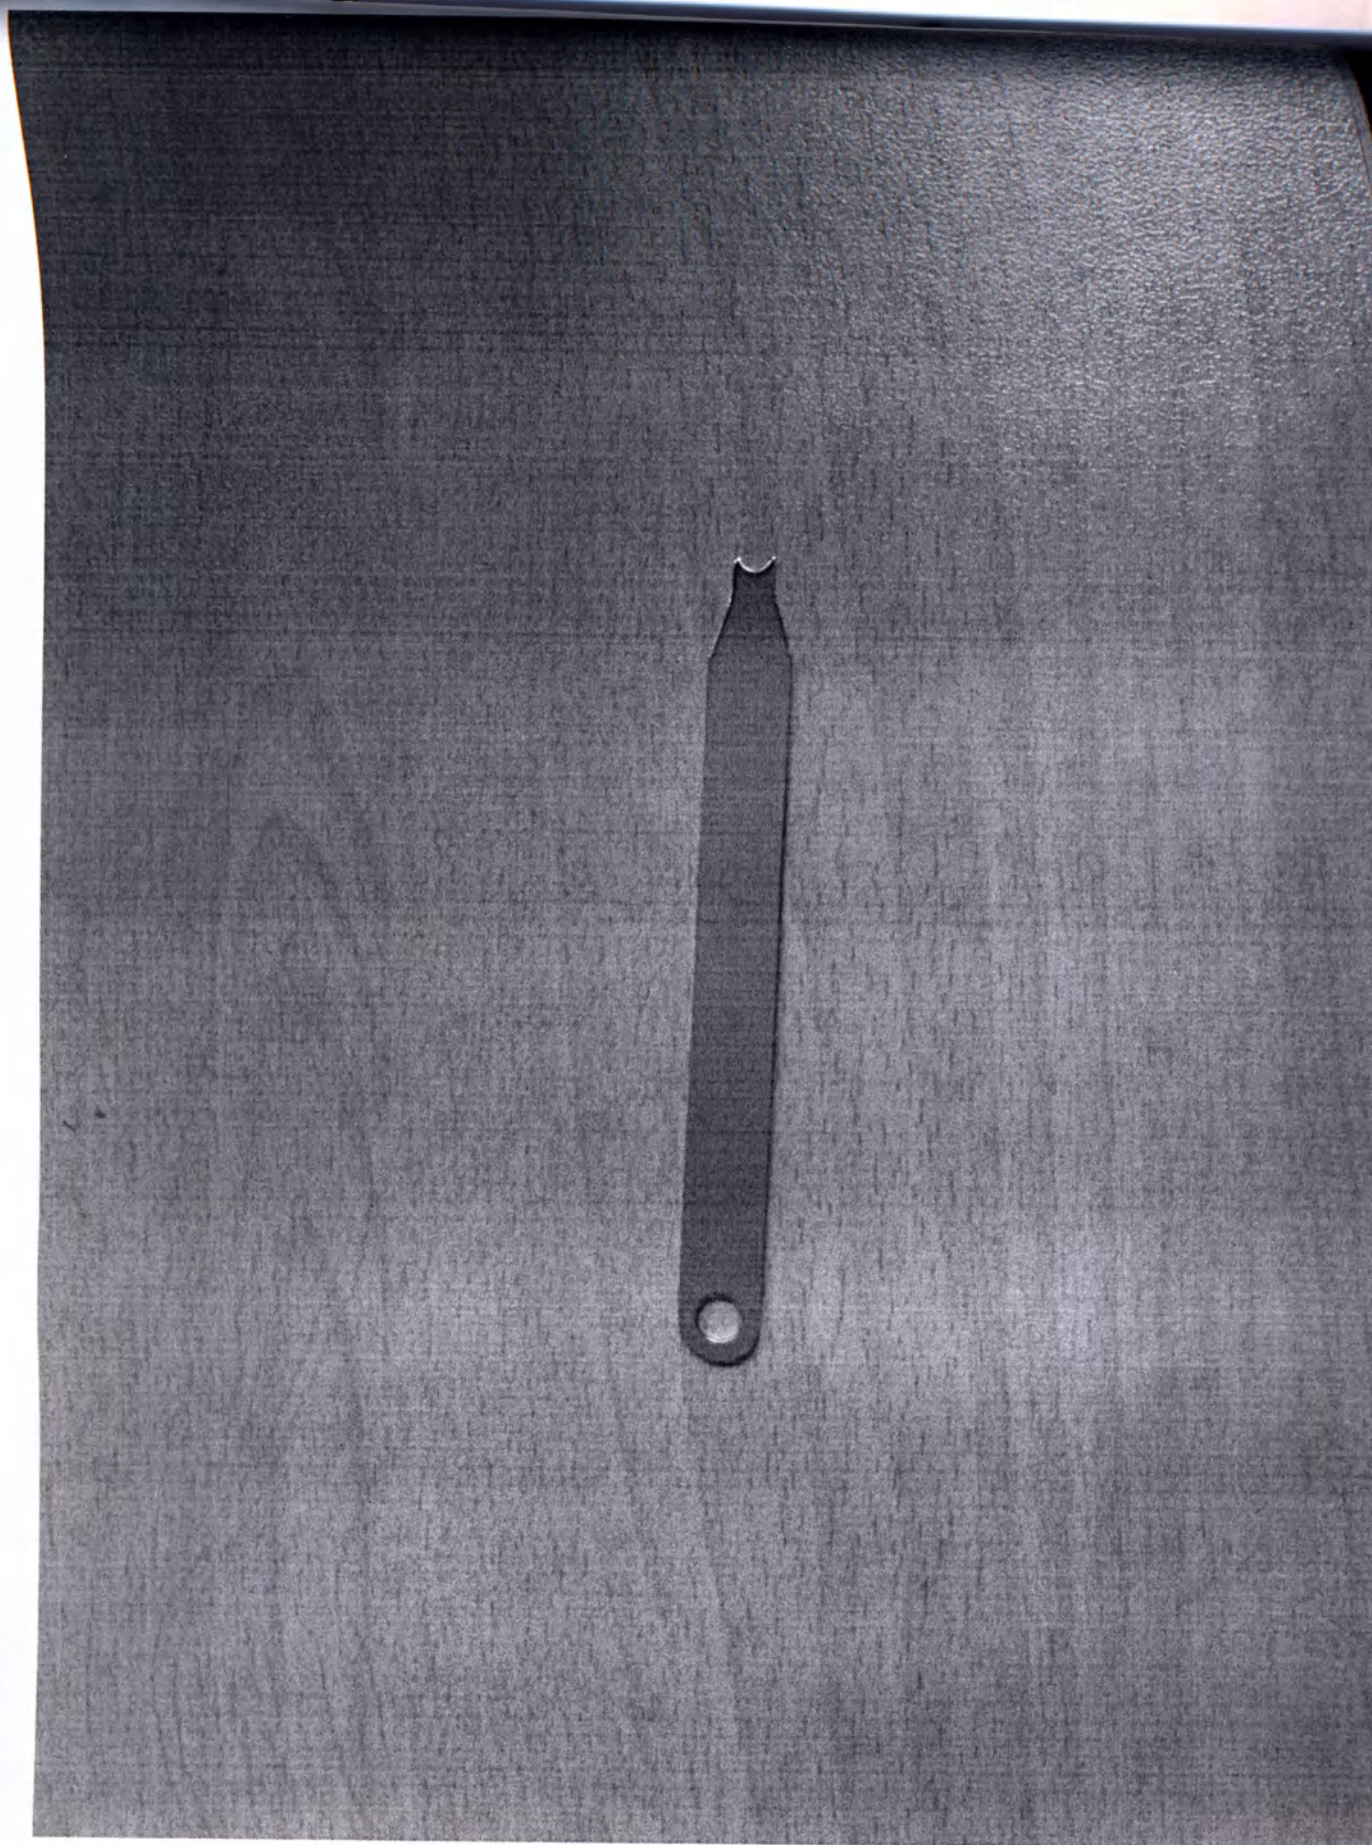


Рис. 24 - Ключ для фиксации панели управления концентратора;



Рис. 25 - Увлажнитель;

Шланг соединительный, длина 2 м, диаметр 5 мм


Мундштук

Резервуар распылителя, 94 x42 мм

Рис. 26 – Комплект для ингаляций;



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПЦ МТ «АРМЕД»

 О.С. Данилова
«11» _____ 2017г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Концентратор кислорода медицинский «АРМЕД»
по ТУ 32.50.21-020-13391002-2017*

варианты исполнения:

8Ф, 8Ф-1/1, 8Ф-1/2, 8Ф-1/3, 8Ф-3, 8Ф-3В,

8Ф-5, 8Ф-5А, 8Ф-5АВ, 8Ф-8, 8Ф-10, 9Ф-3, 9Ф-3В

с принадлежностями

*Перед использованием необходима консультация врача
и ознакомление с настоящим Руководством!*



Принято к производству
29 (двадцать девять) июля.

А. А. Щукарев