

Фотографии медицинского изделия:
«Облучатель-рециркулятор «АРМЕД» AirCube по ТУ 32.50.50-027-13391002-2020»,
производство: ООО «НПЦ МТ «АРМЕД», Россия


Содержание:


- I. Варианты исполнения: 115 MDF, 130 MDF, 215 MDF, 230 MDF, 315 MDF, 330 MDF
- II. Макет этикетки
- III. Макет потребительской упаковки


Генеральный директор
ООО «НПЦ МТ «АРМЕД»





/ А.А. Щукарев /

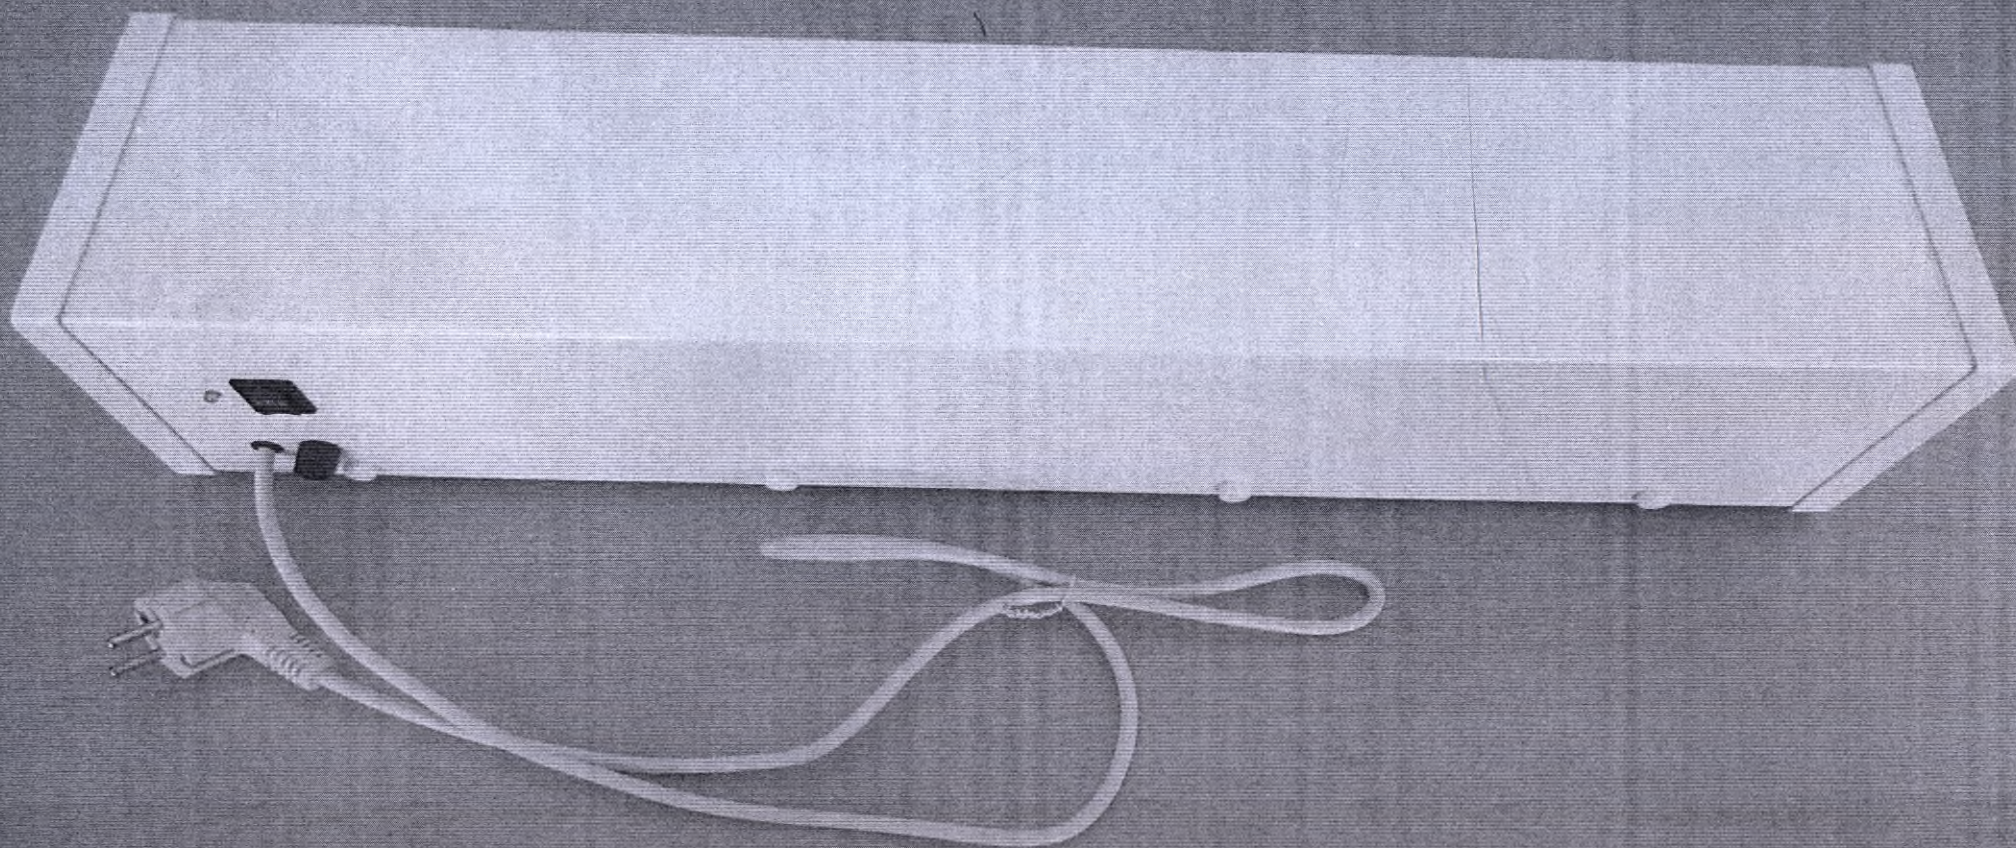


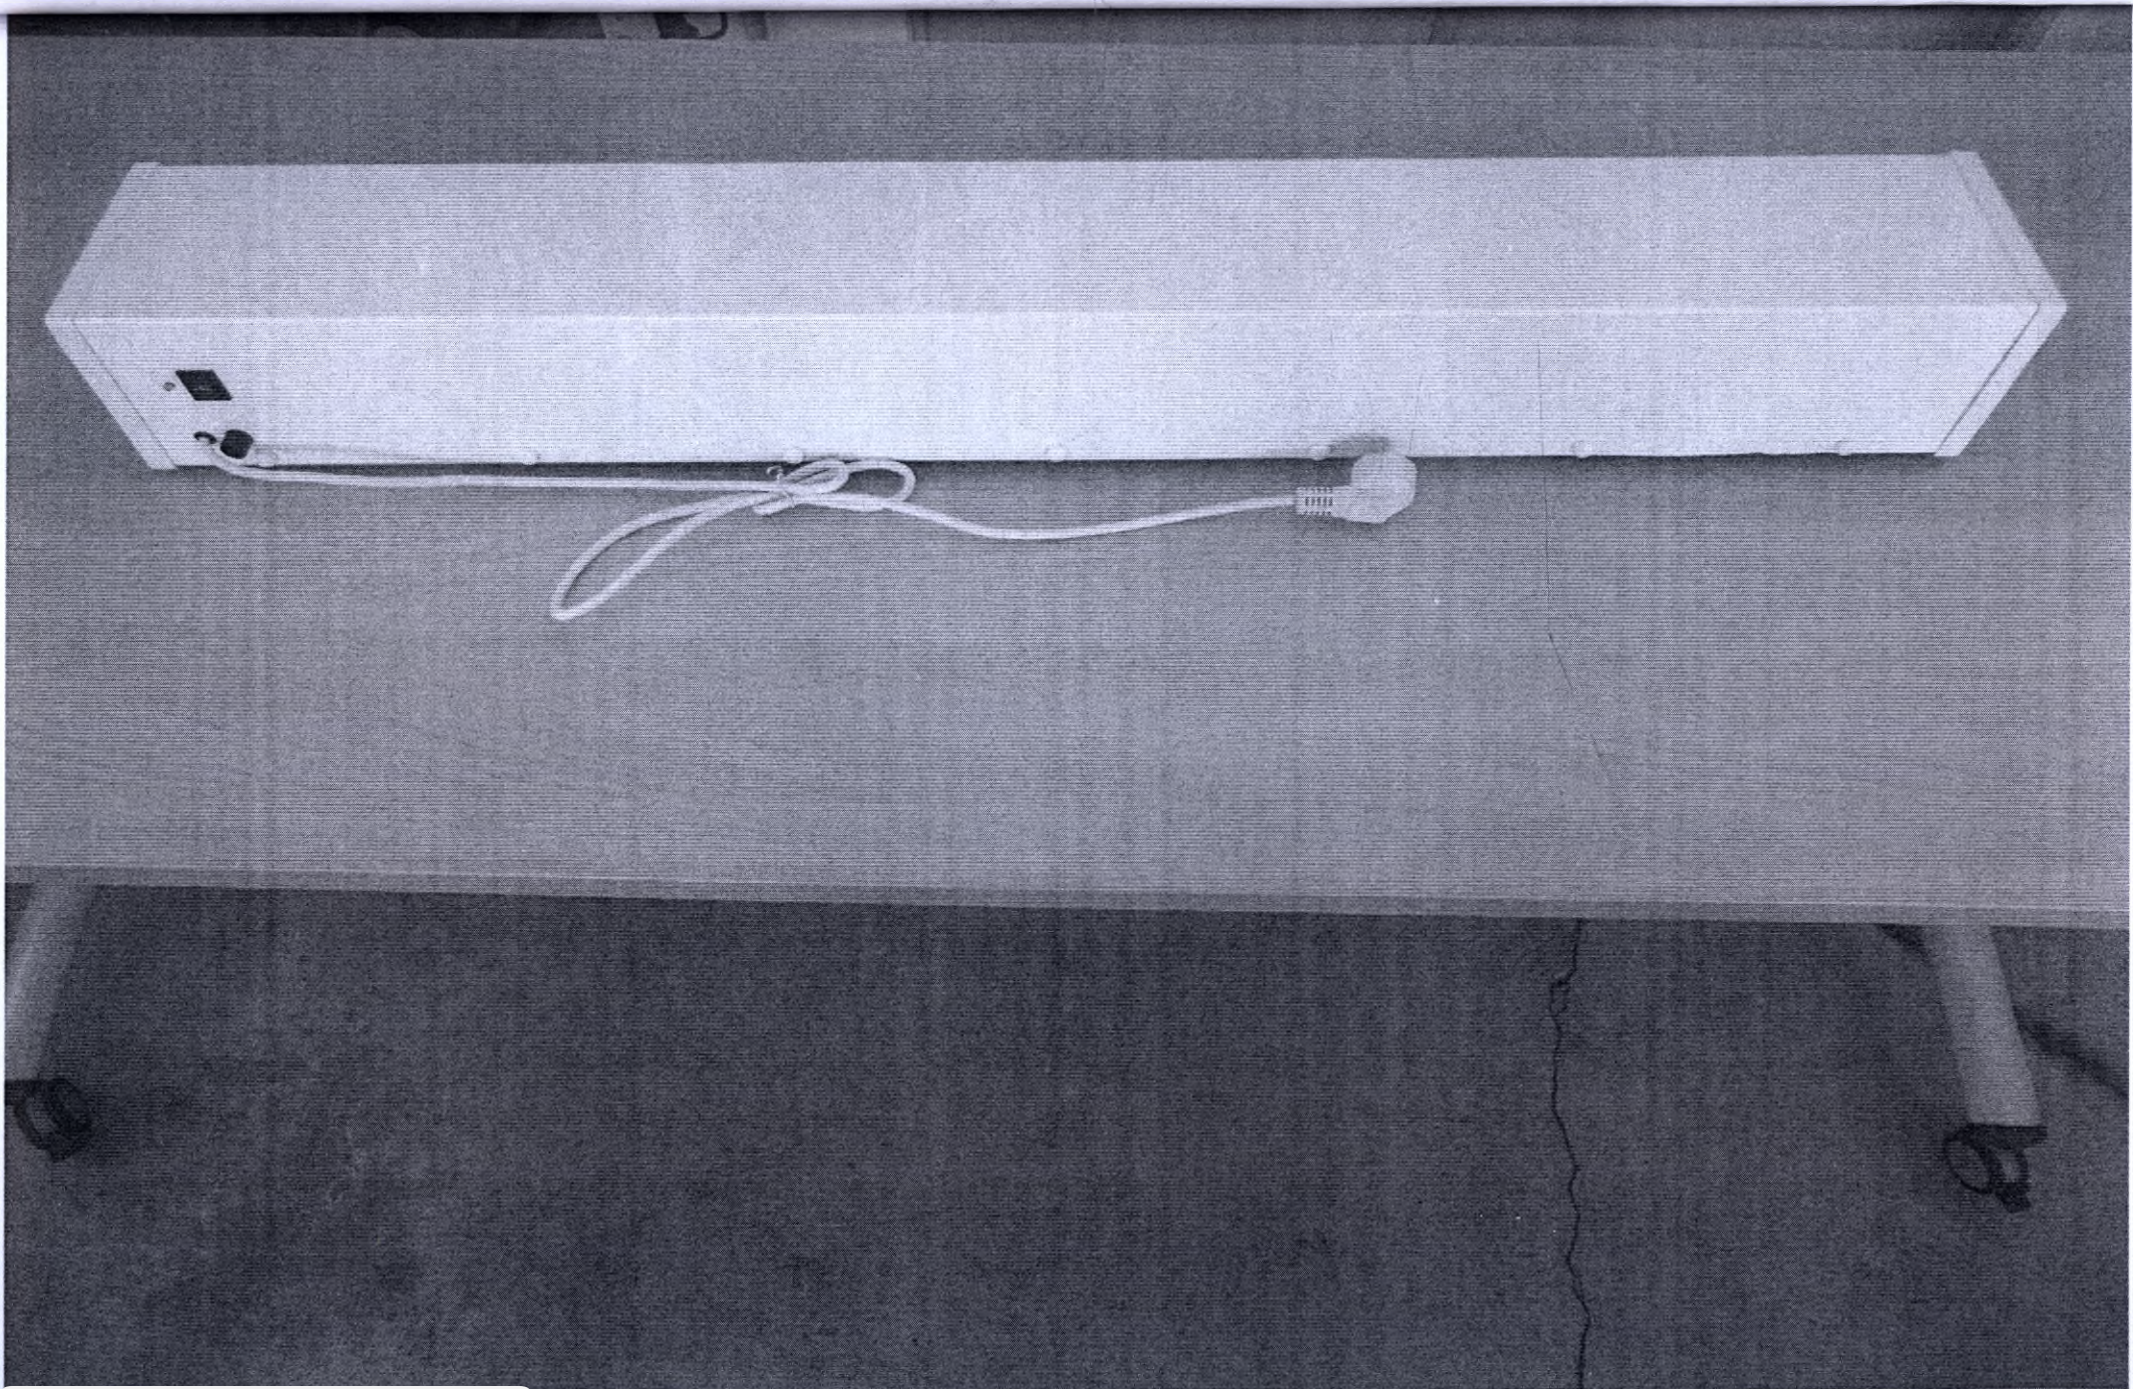

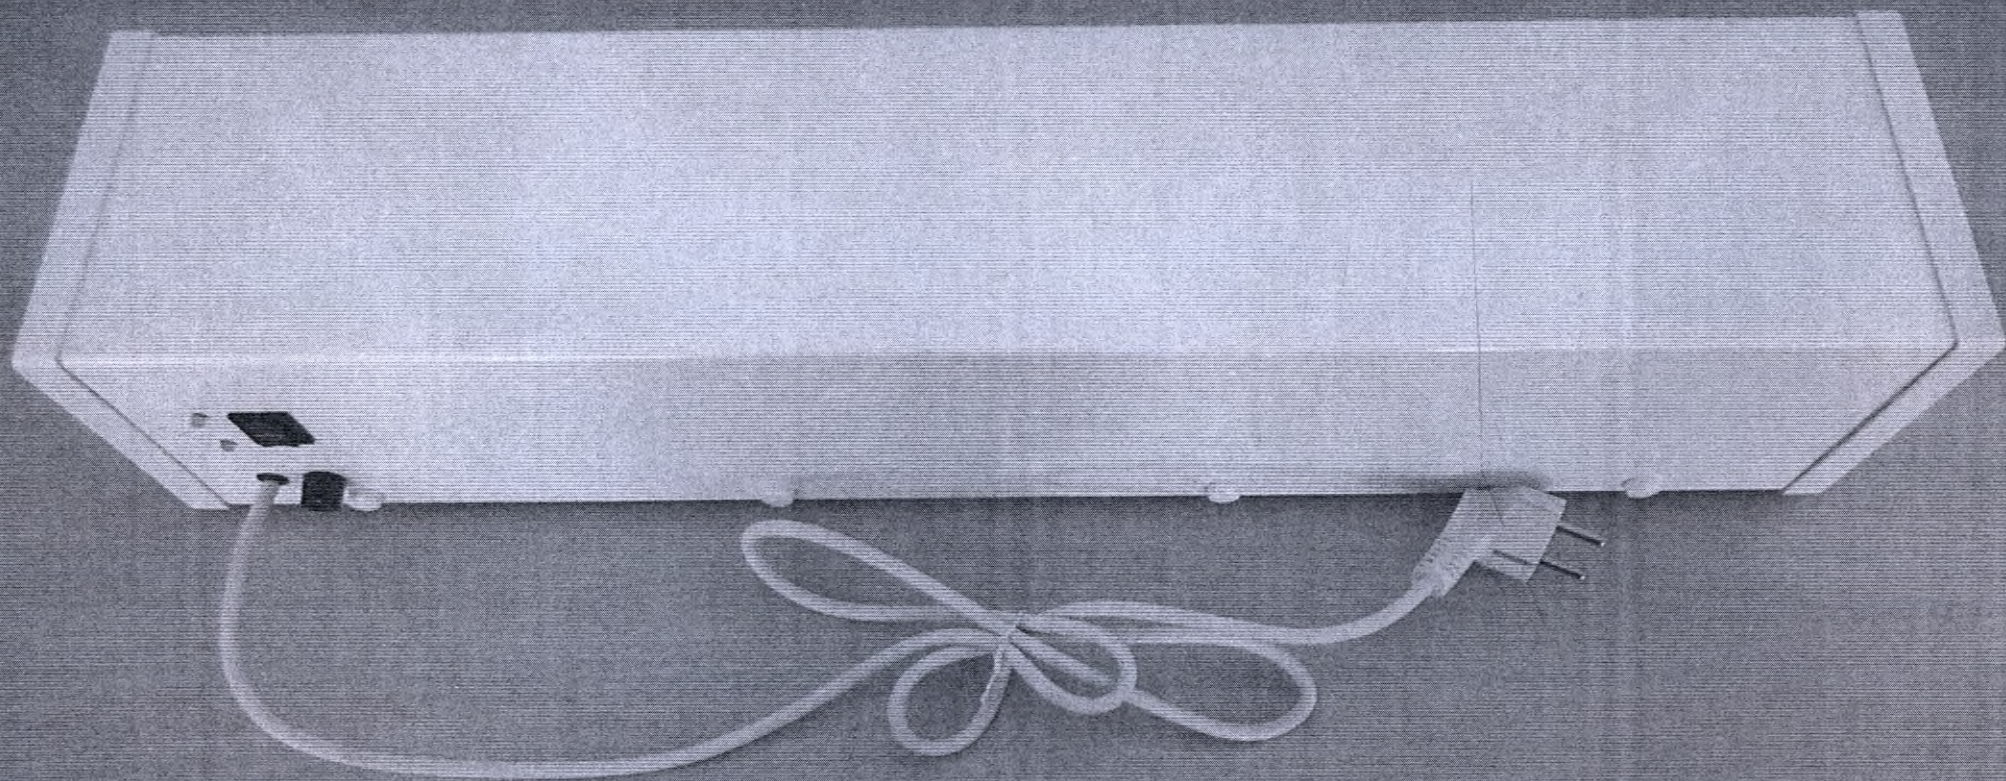

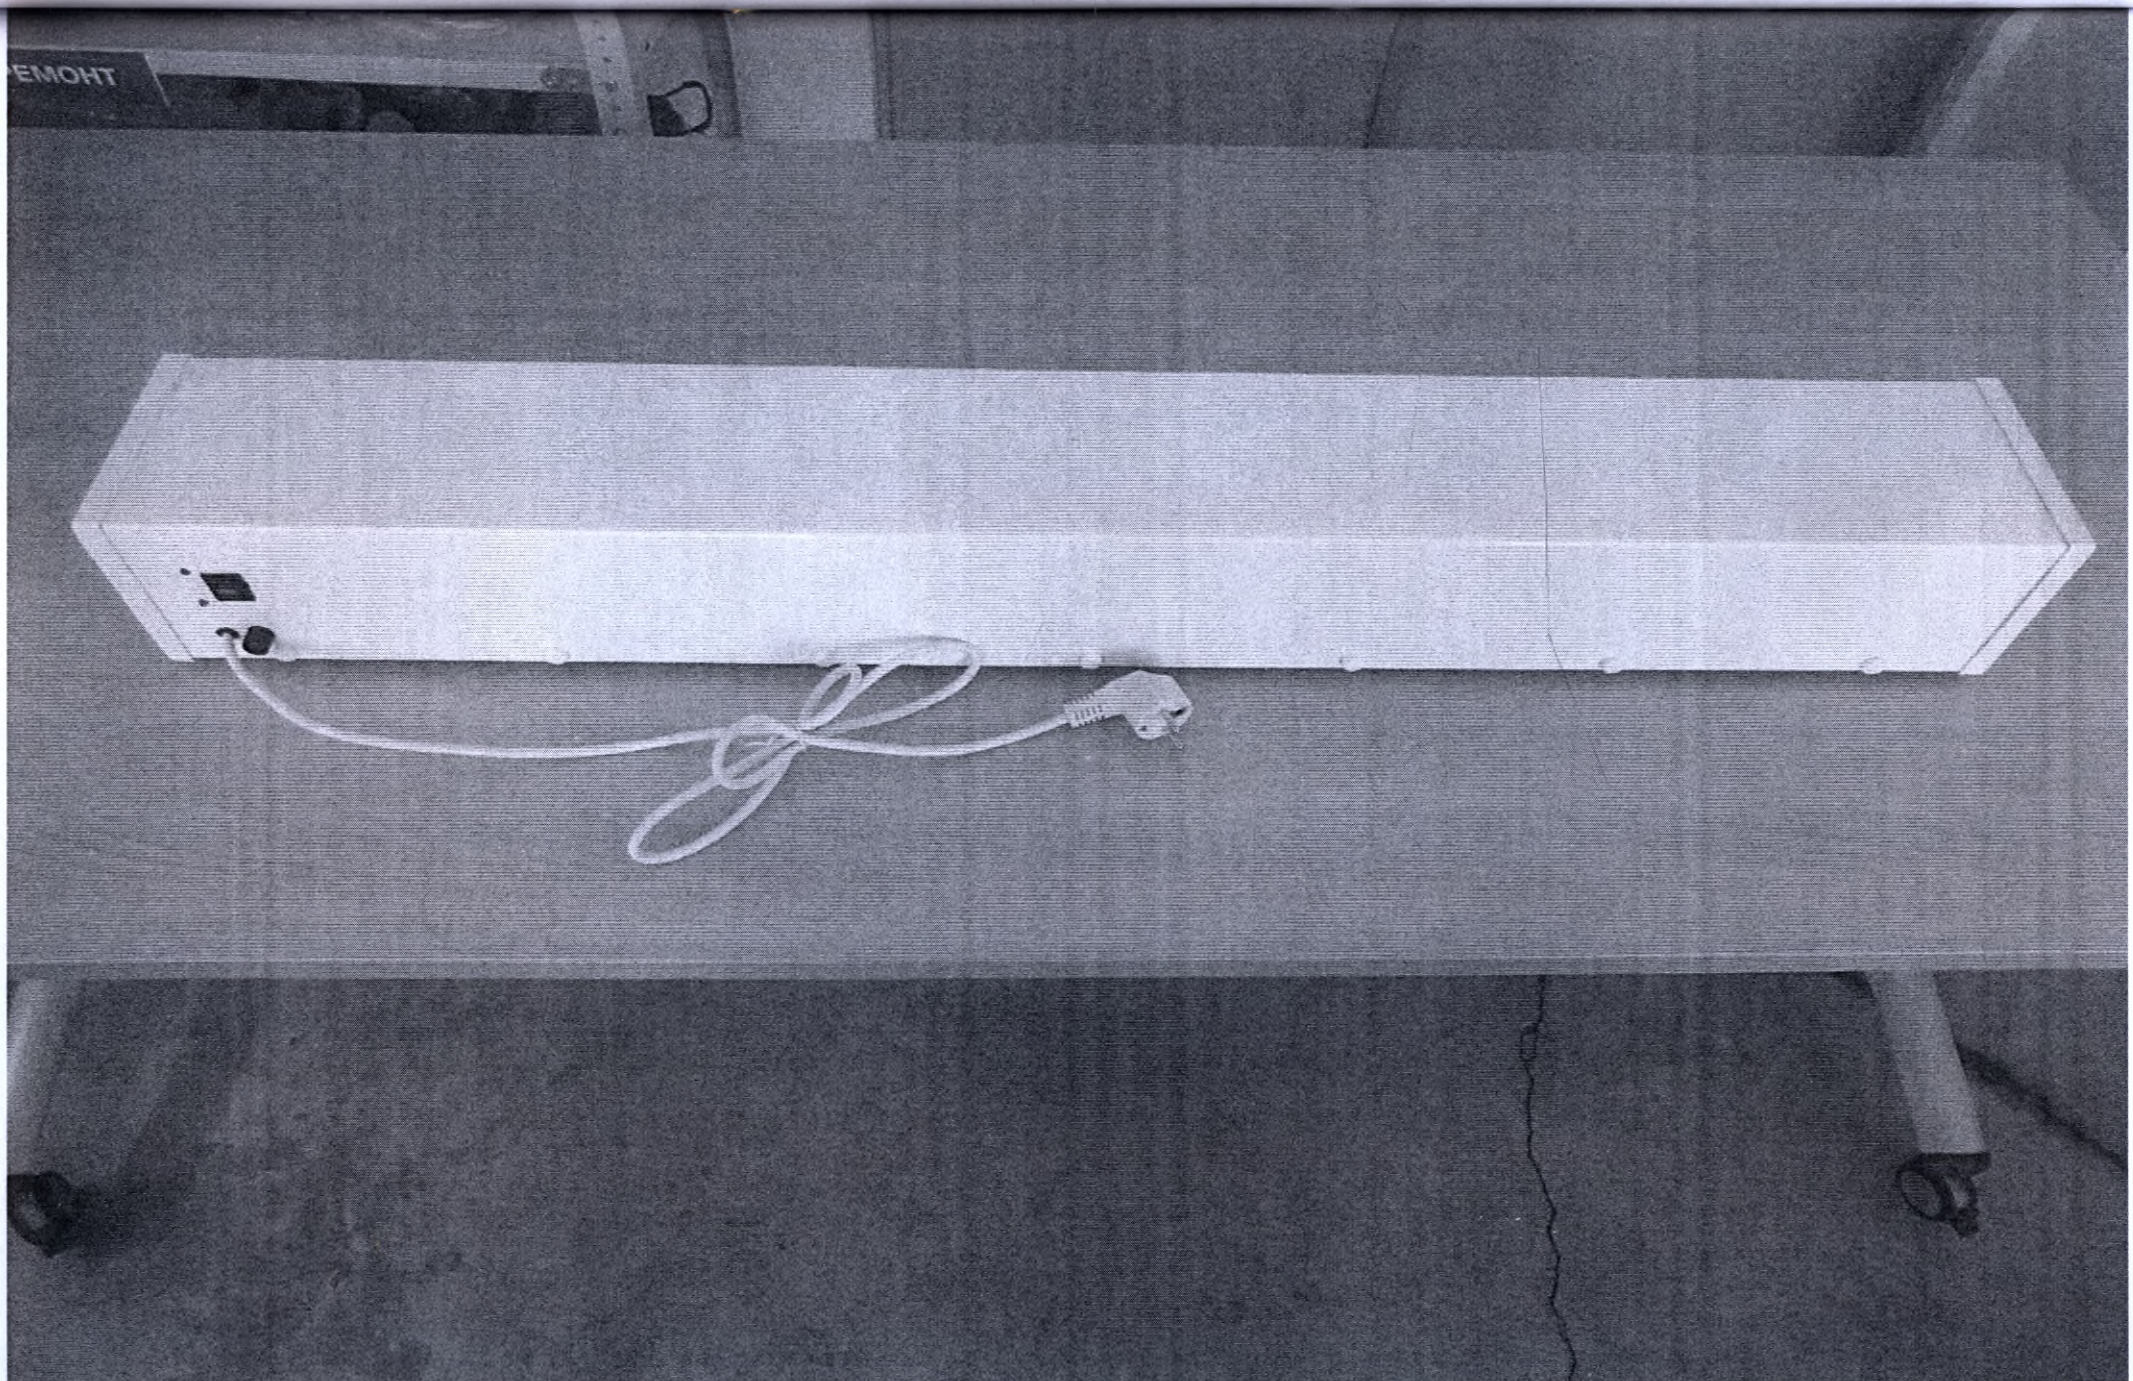

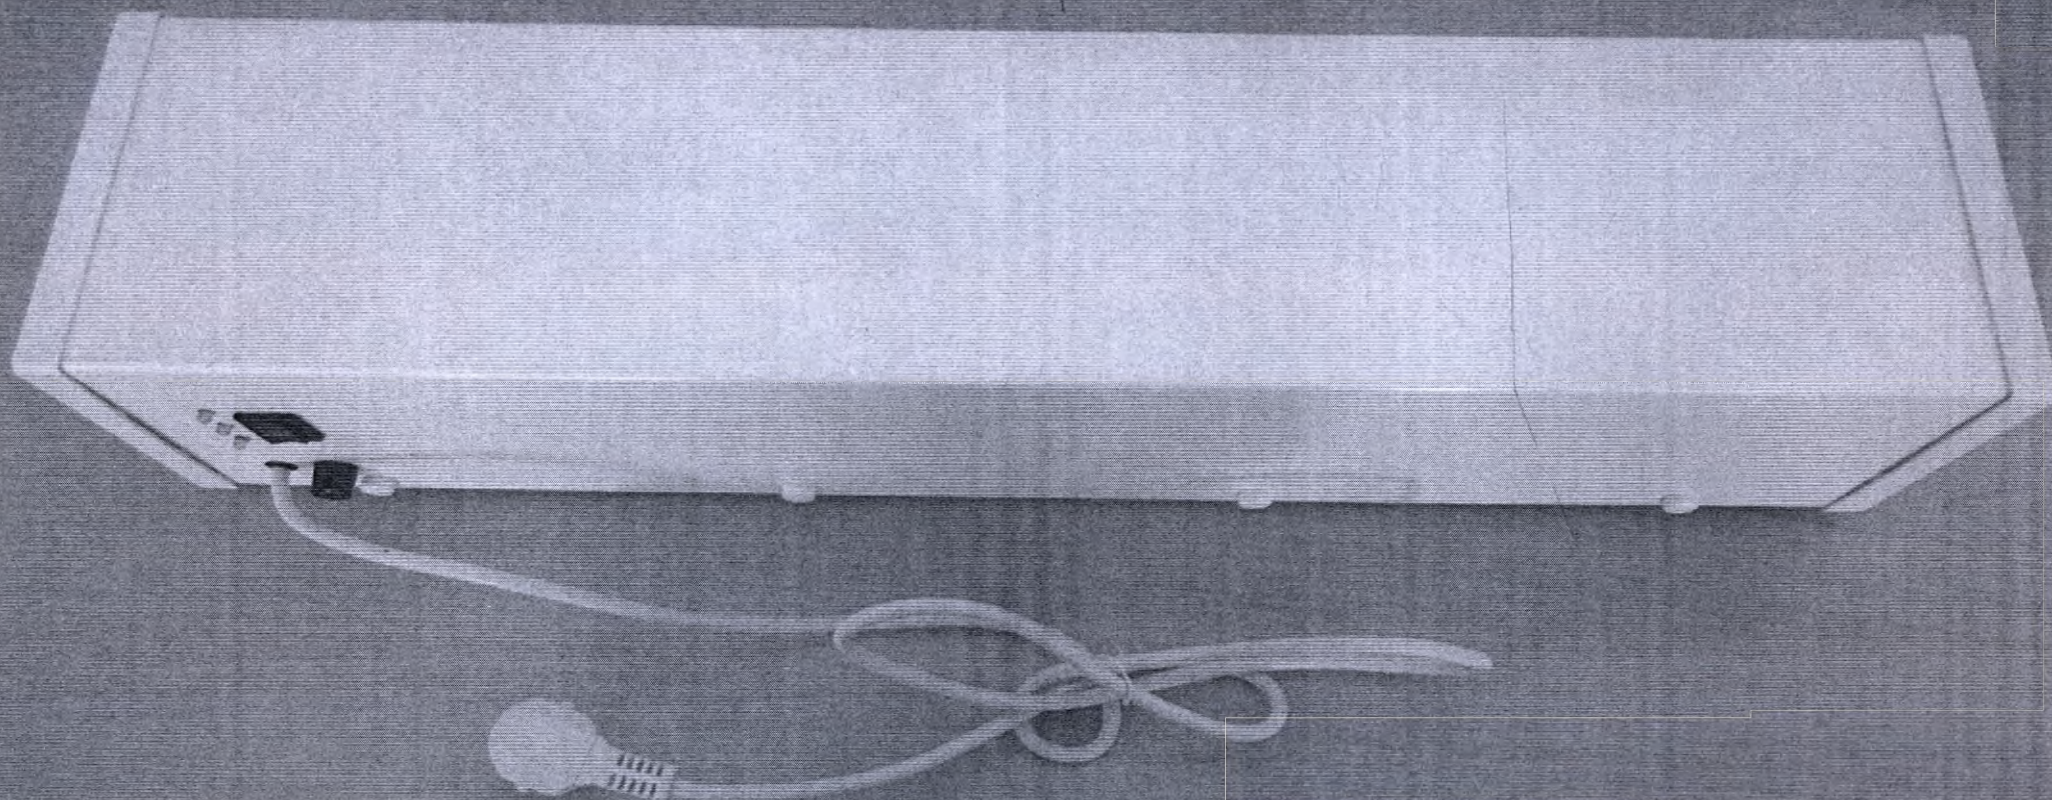

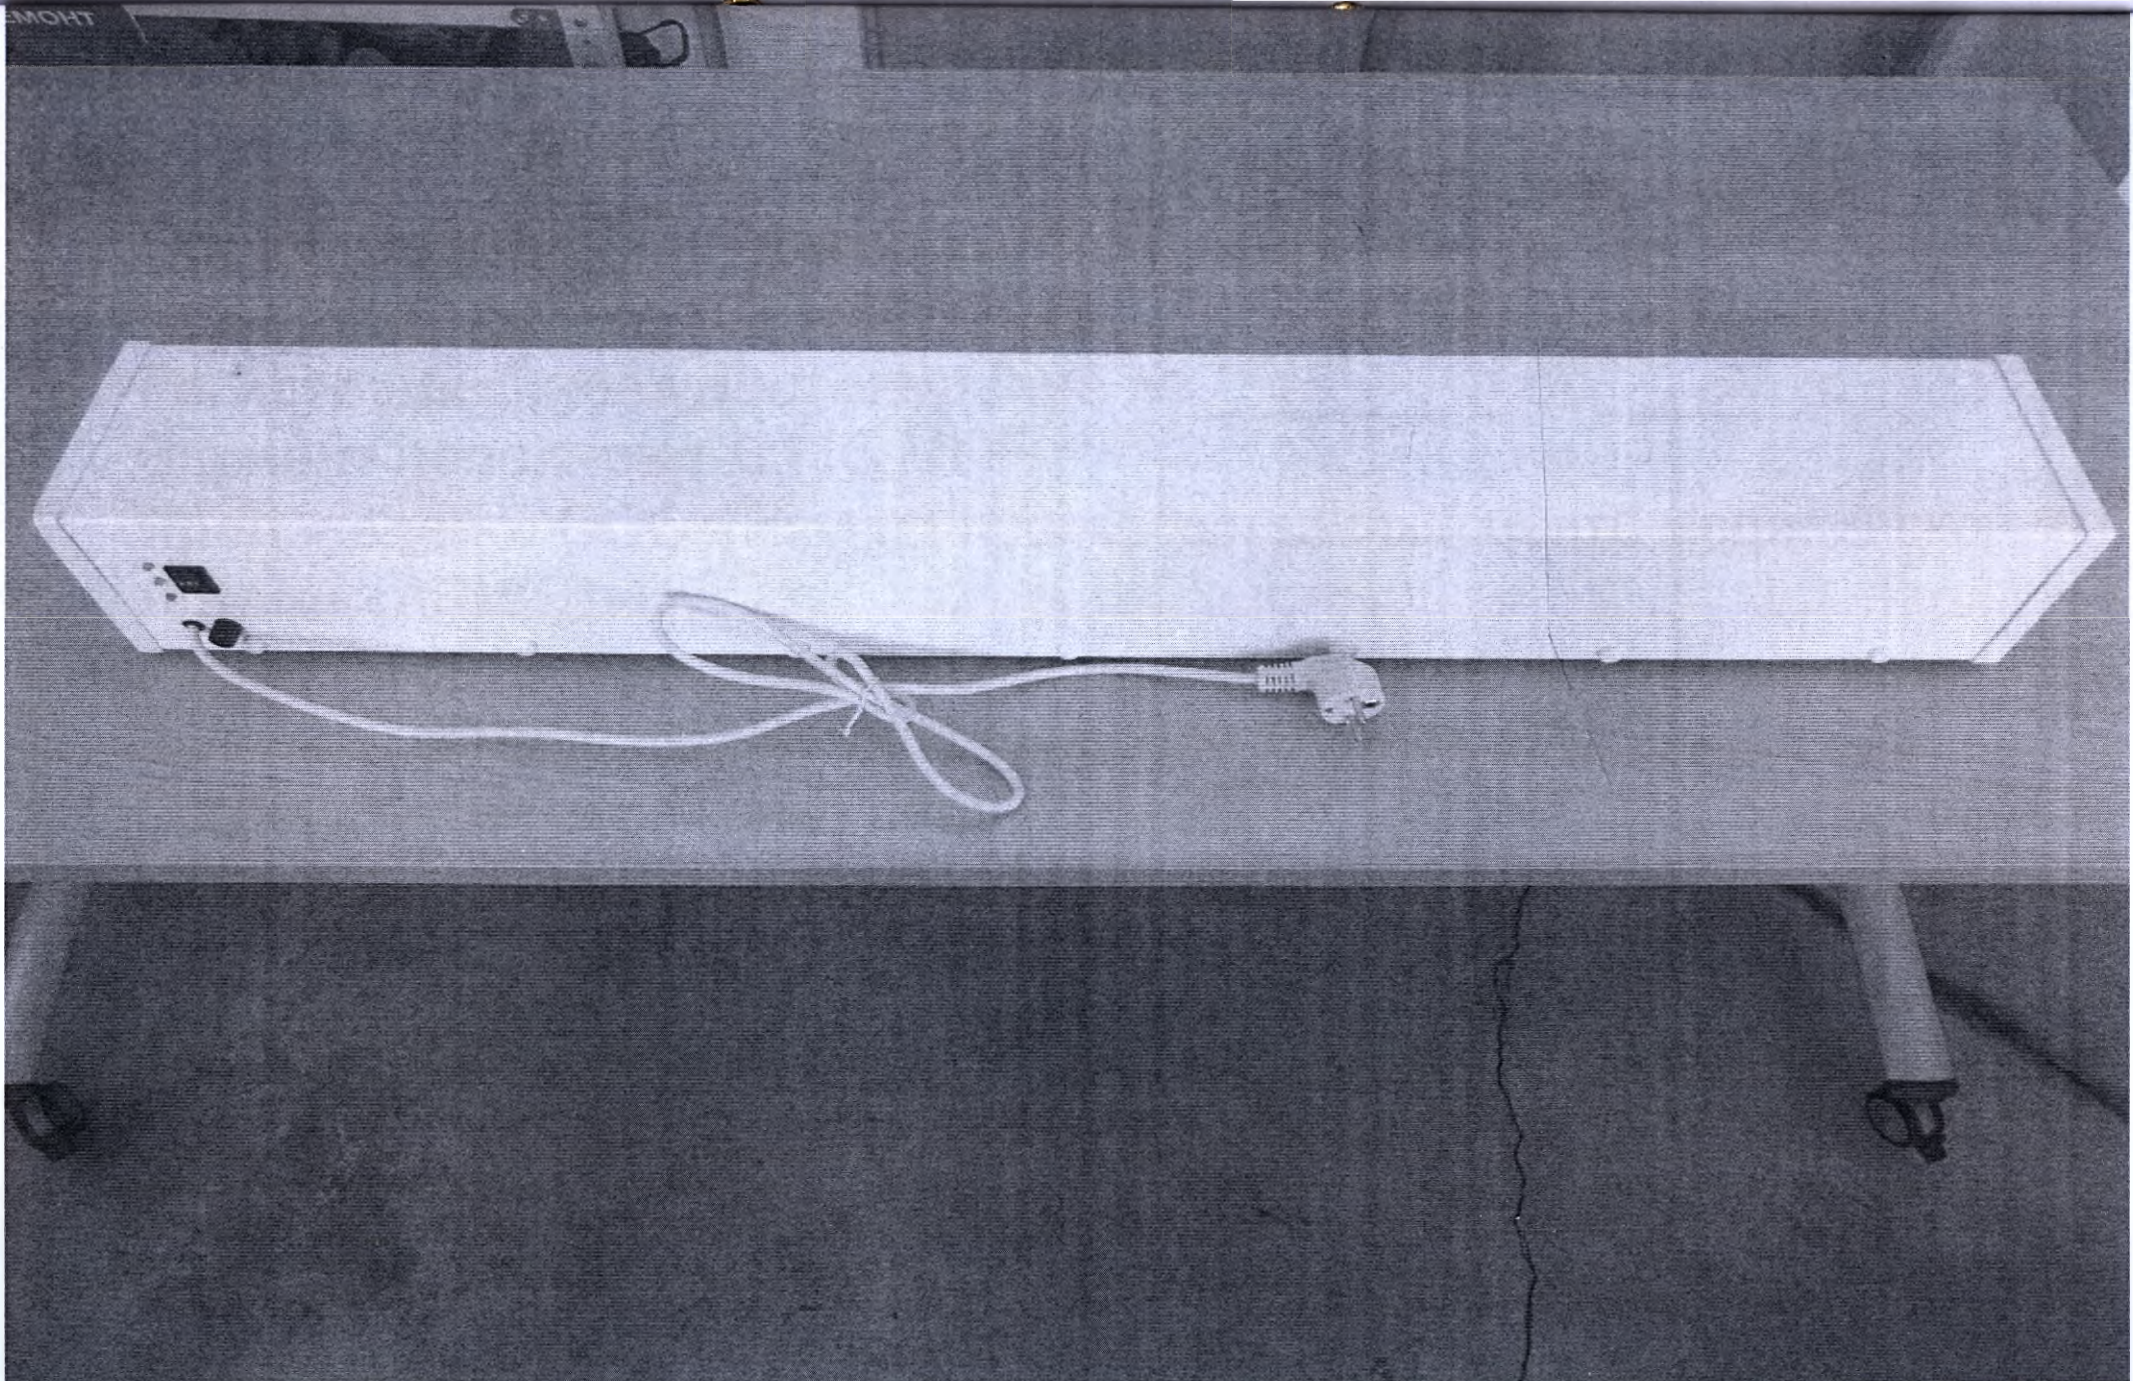



Облучатель-рециркулятор «АРМЕД» AirCube
по ТУ 32.50.50-027-13391002-2020

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Вариант исполнения: 115 MDF

Произведено: ООО «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД»

Адрес: 143912, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов,
Западная коммунальная зона, владение 1А, пом. 1/1


Номинальное напряжение сети: (220 ± 22) В

Номинальная частота питающей сети: (50 ± 1) Гц

Потребляемая мощность при номинальном режиме работы:
не более 30 Вт

Дата выпуска: 10.2020

Серийный номер: 11500001





Облучатель-рециркулятор «АРМЕД» AirCube
по ТУ 32.50.50-027-13391002-2020

□ 115 MDF



□ 215 MDF



□ 315 MDF



✦ Встроенный фильтр

●●● Диодный индикатор


www.armed.ru


СДЕЛАНО
В РОССИИ

Произведено: ООО «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД»
Адрес: 143912, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, Заводная коммунальная зона, здание №1, пом. 1/1
РУ № _____ от _____ г.

Год и месяц изготовления:

Перед применением проконсультируйтесь с
врачом и внимательно изучите
Руководство по эксплуатации!



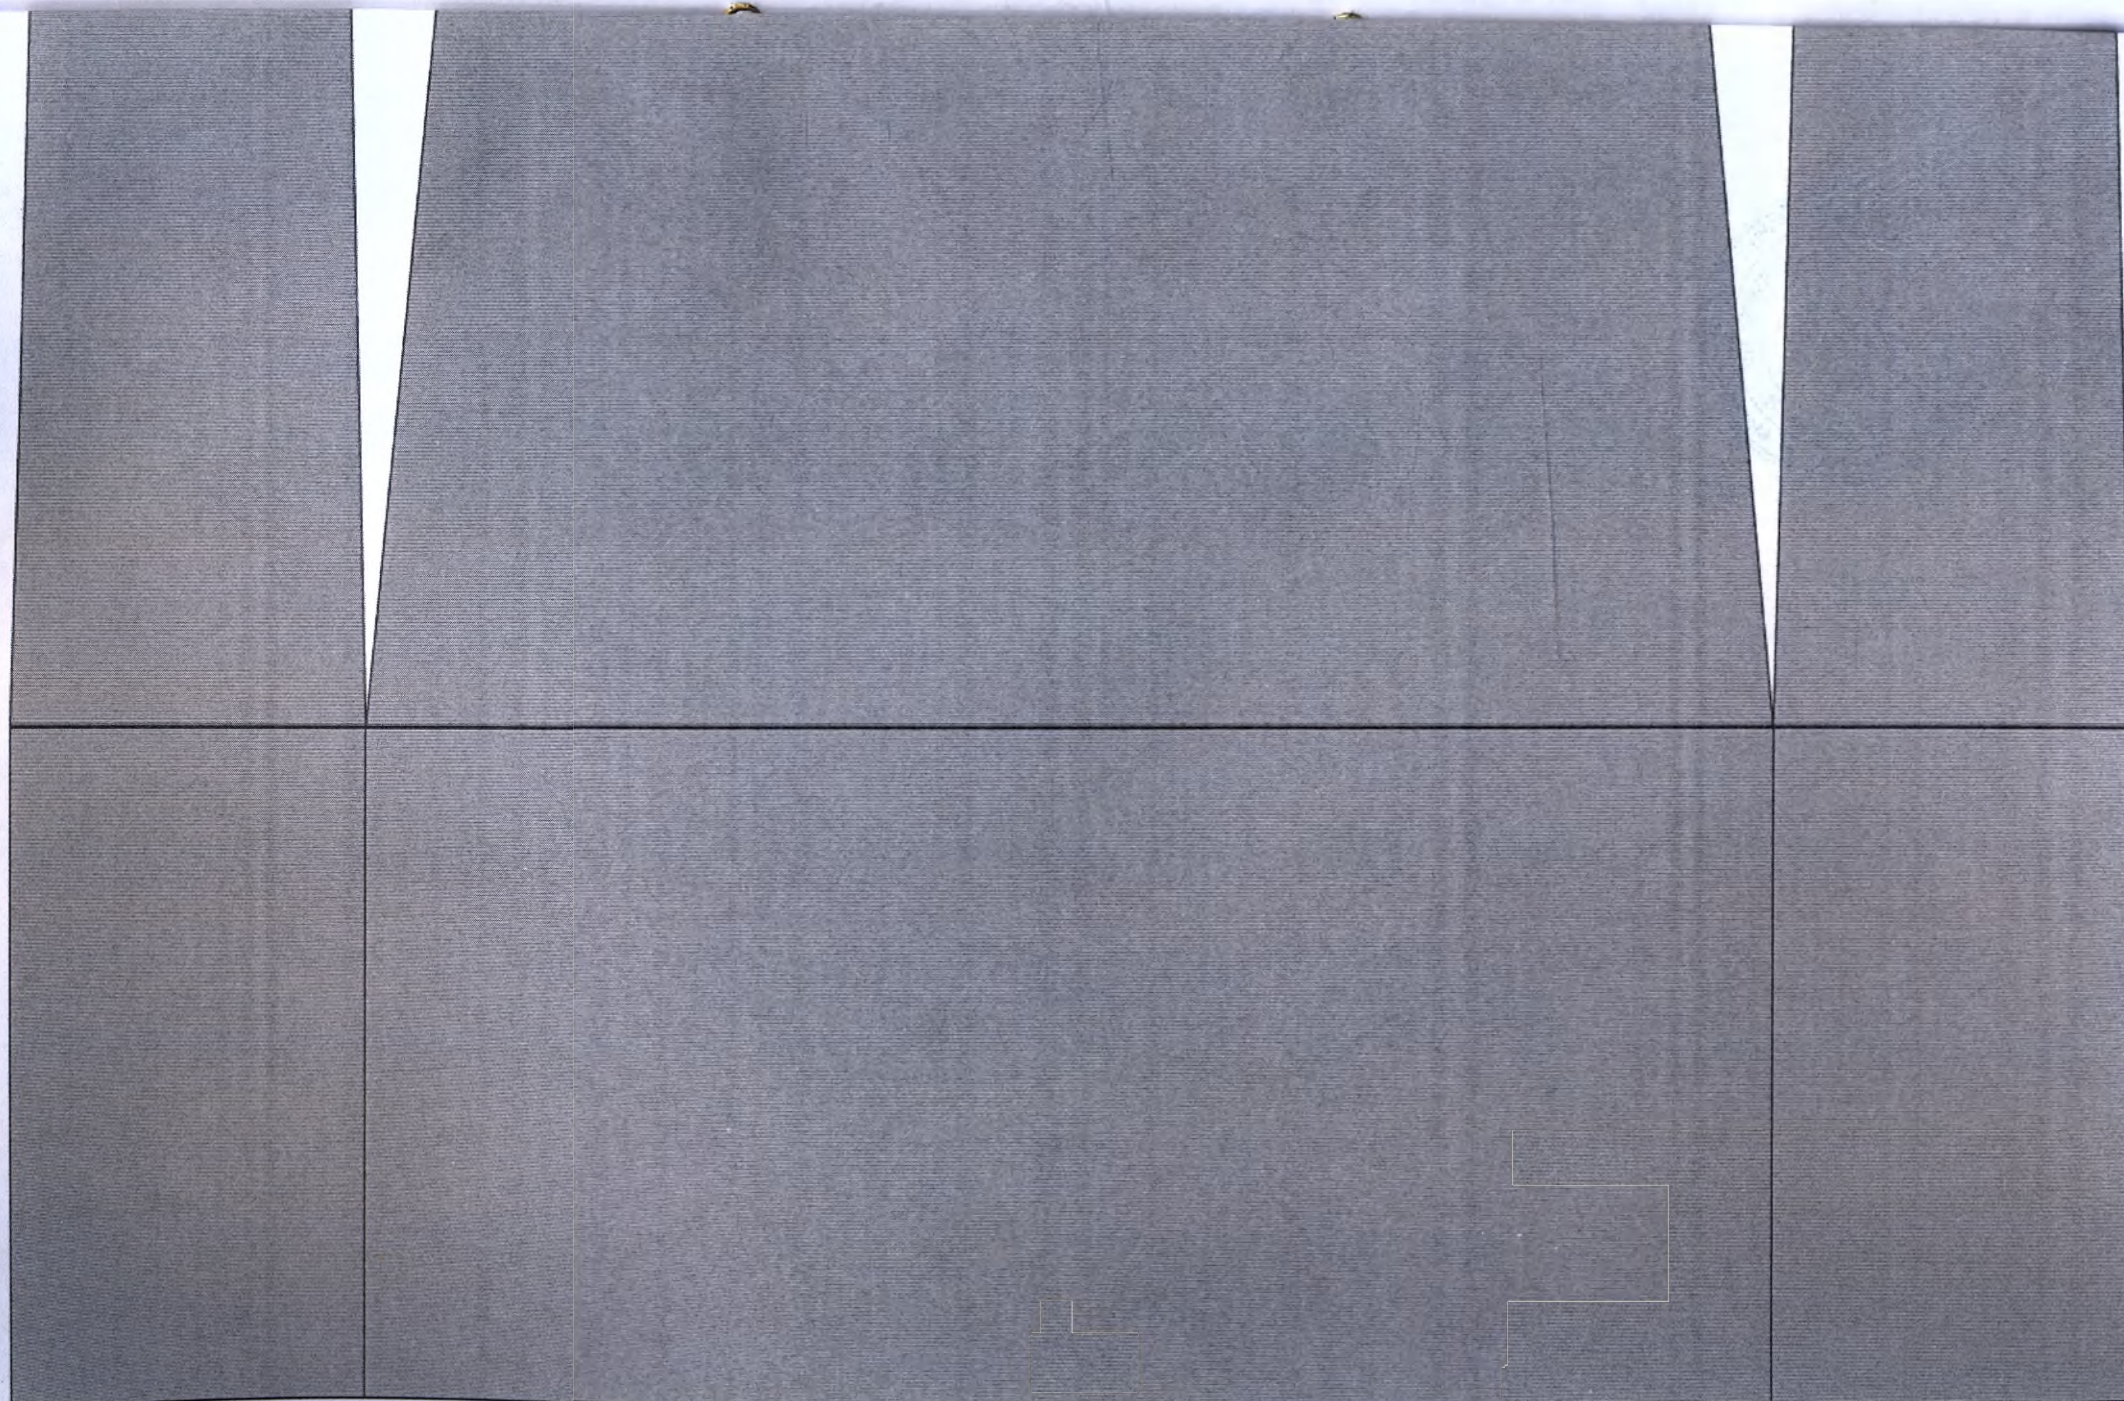

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 10
(двух) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «НИЦМТ-АРМЕД»
А.А.А.А.А.А.

