

DIACONT



ООО «Диаконт» ИНН 7714792851, г. Москва, 125284, ул. Беговая дом 13, кв. 90, Тел. +7(495)971-1944,
diacontru.com

e-mail: diacont@diacontru.com www.

Фотографические изображения

медицинского изделия

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont», в вариантах исполнения

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


ООО «ДИАКОНТ»



Шишко П.И.


«02» октябрь 2024 г.

1. Глюкометр Diacont – 1 шт.

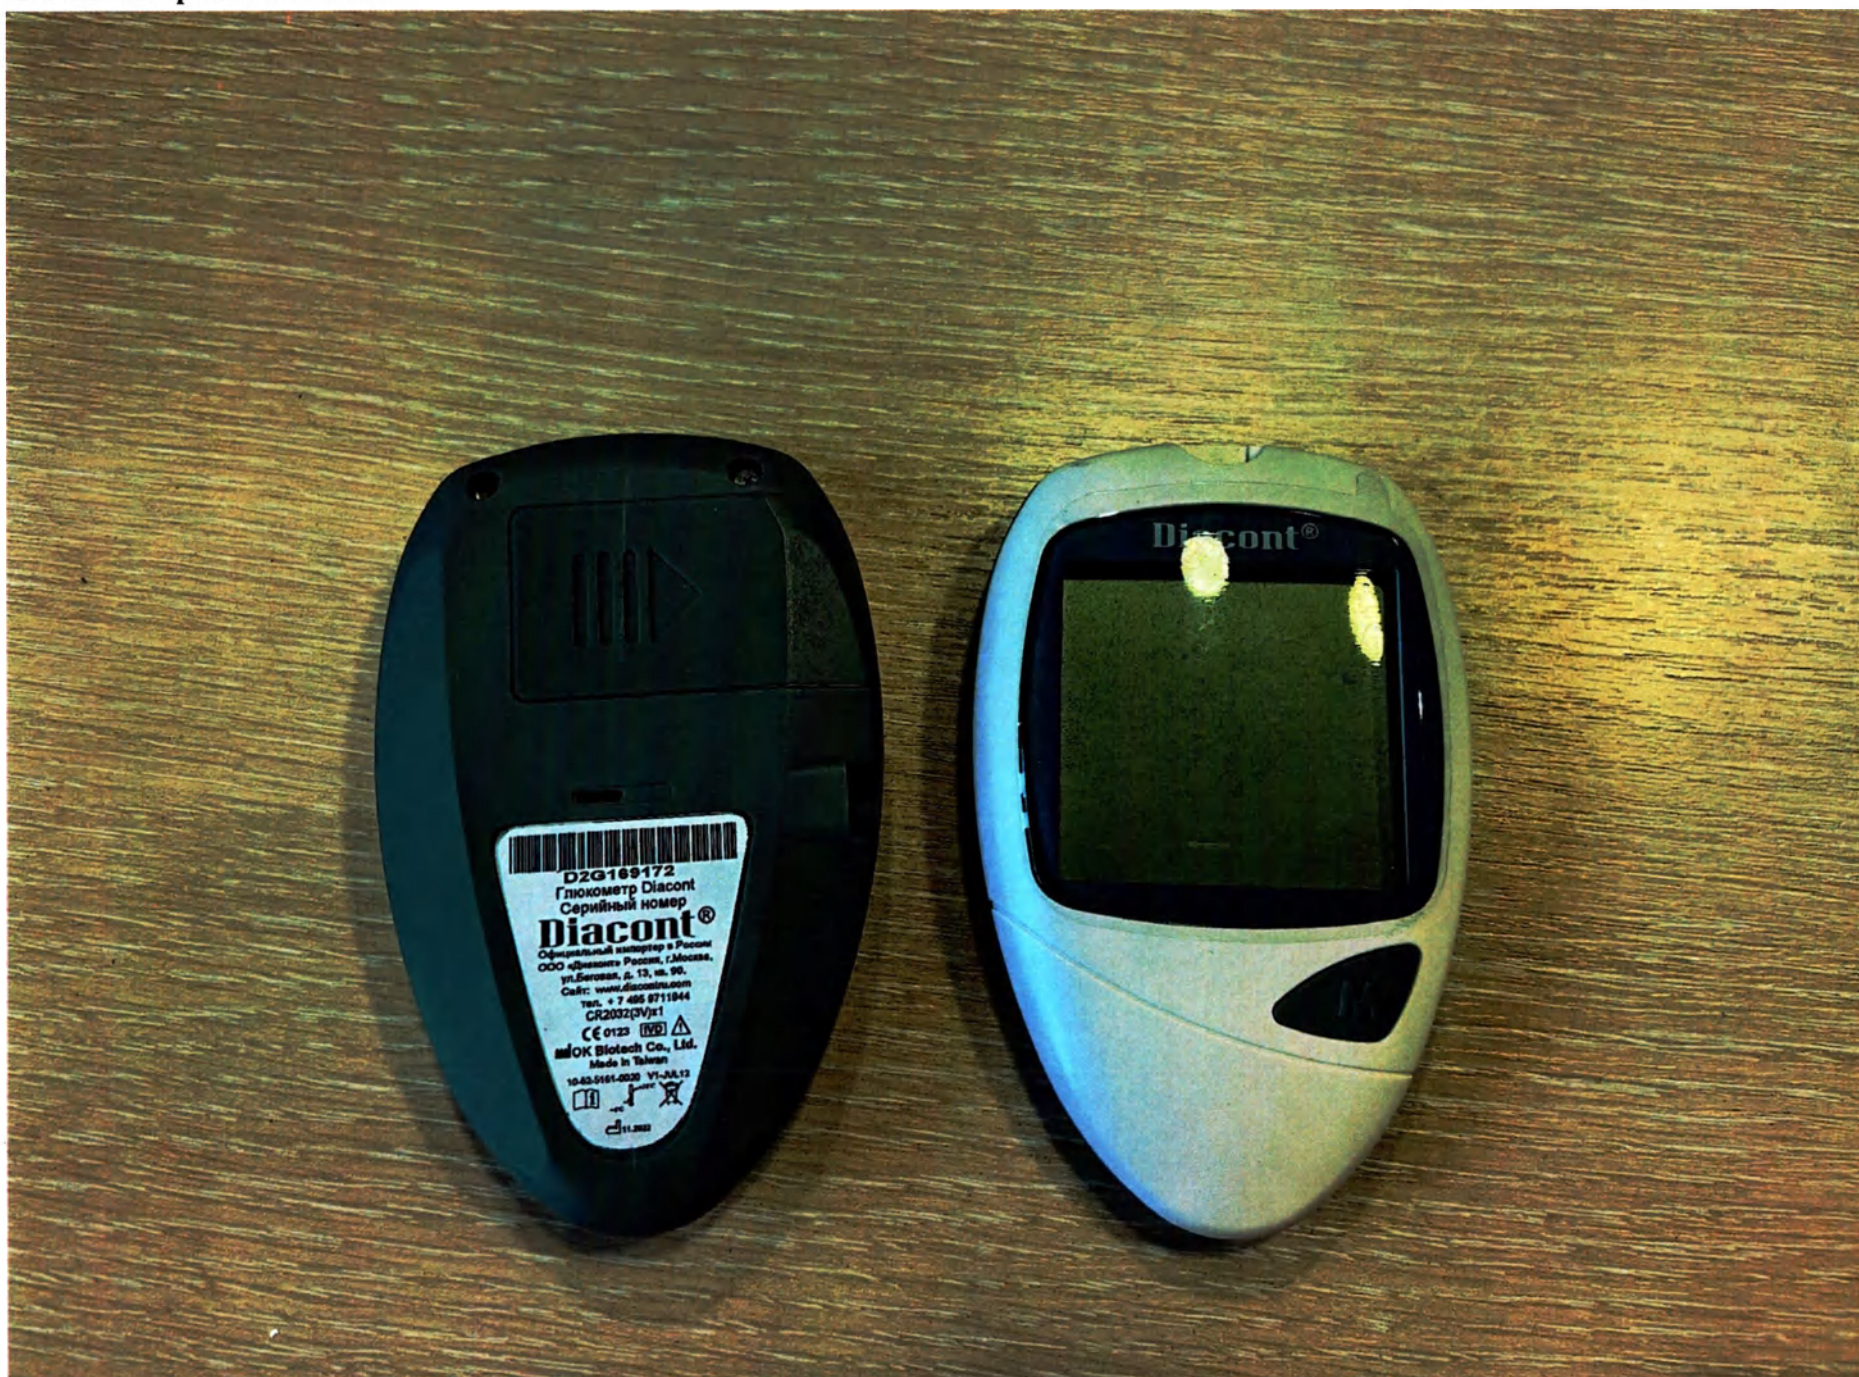

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» в составе:

2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diacont, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2012/12700

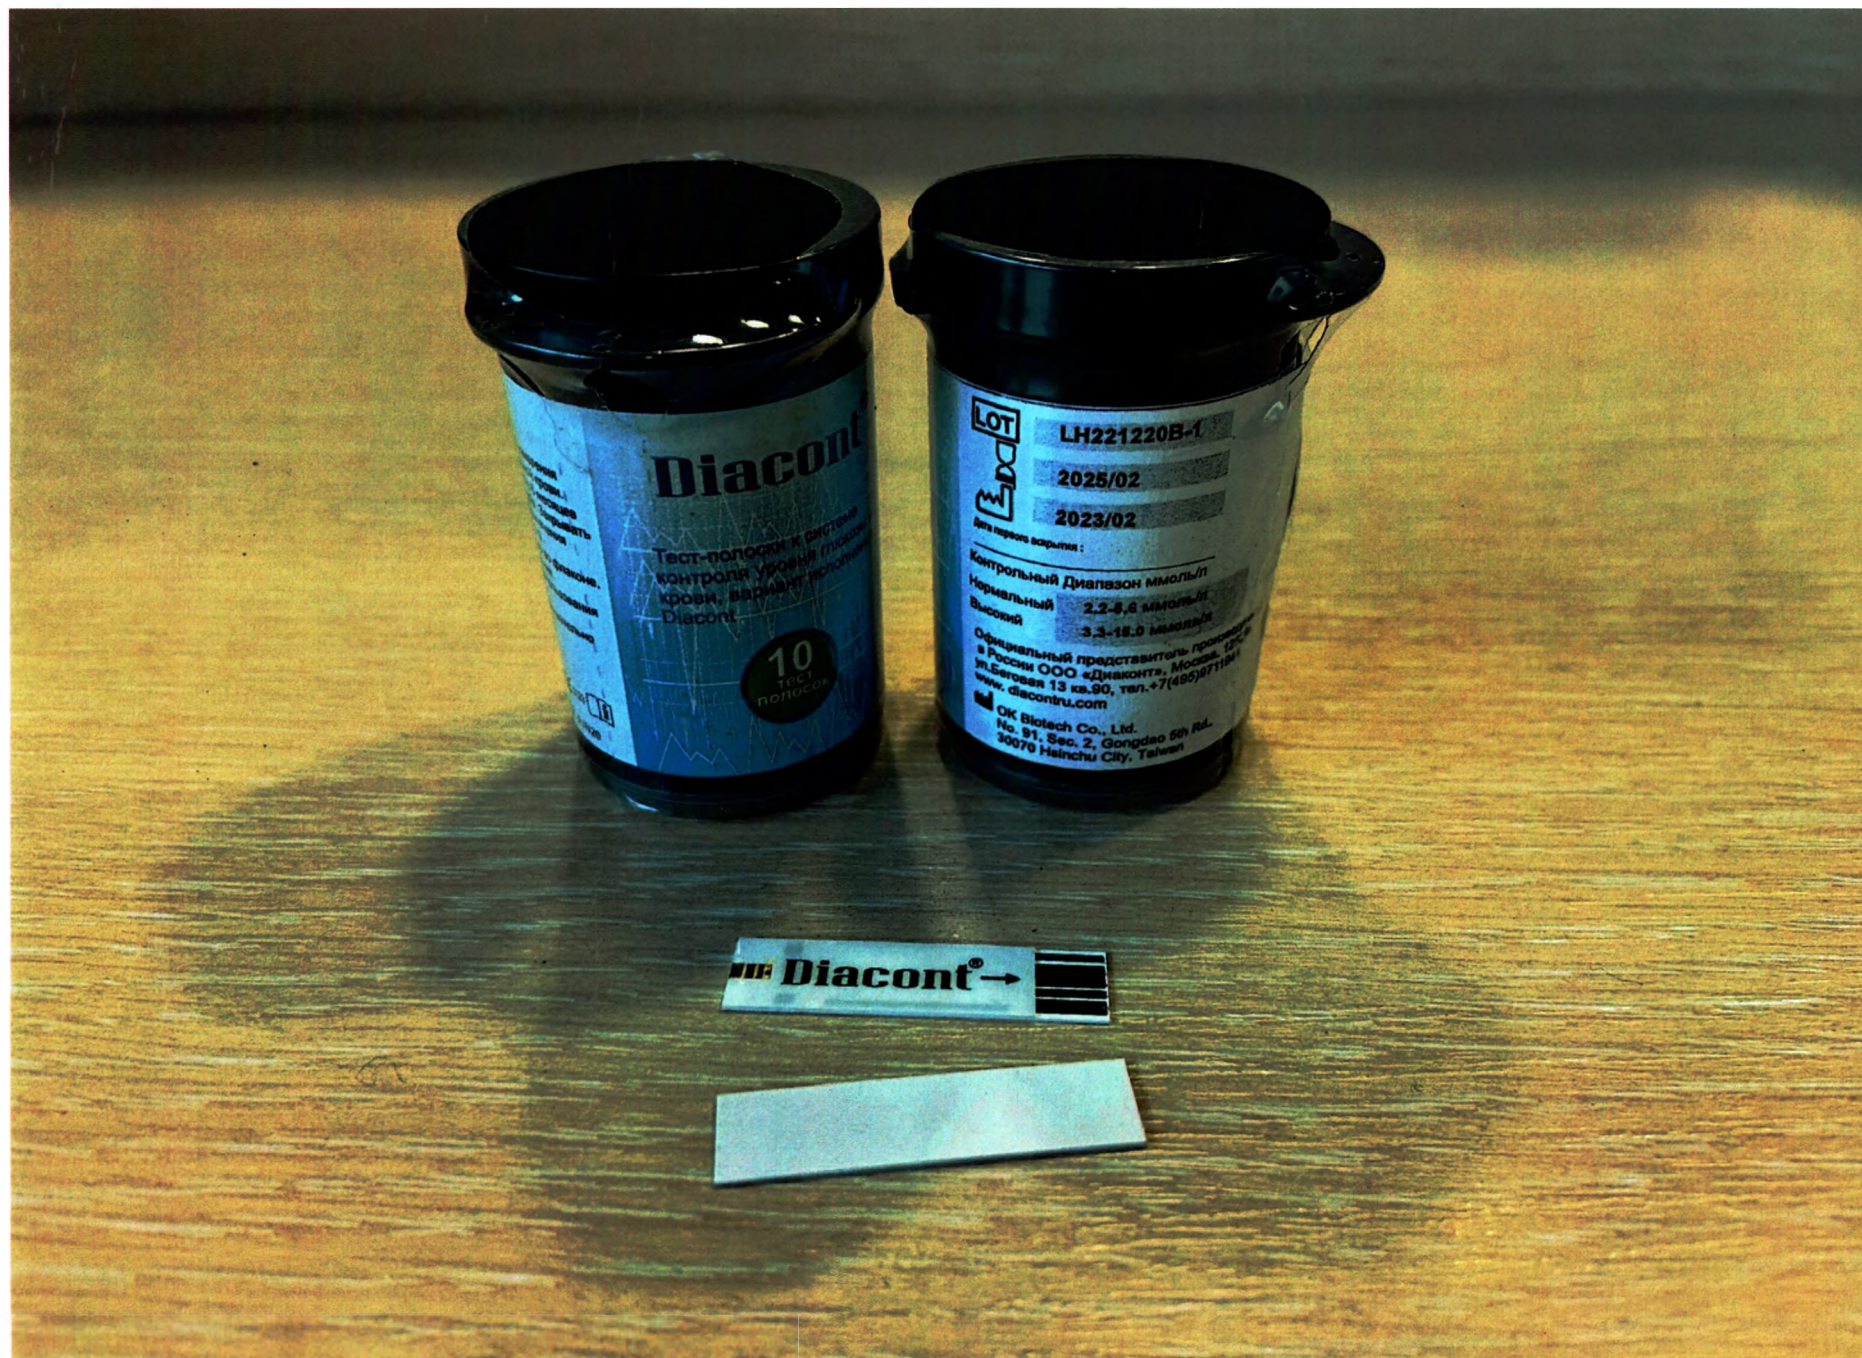

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» в составе:


4

3. Скарификатор Diacont в комплекте со стерильными ланцетами, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698







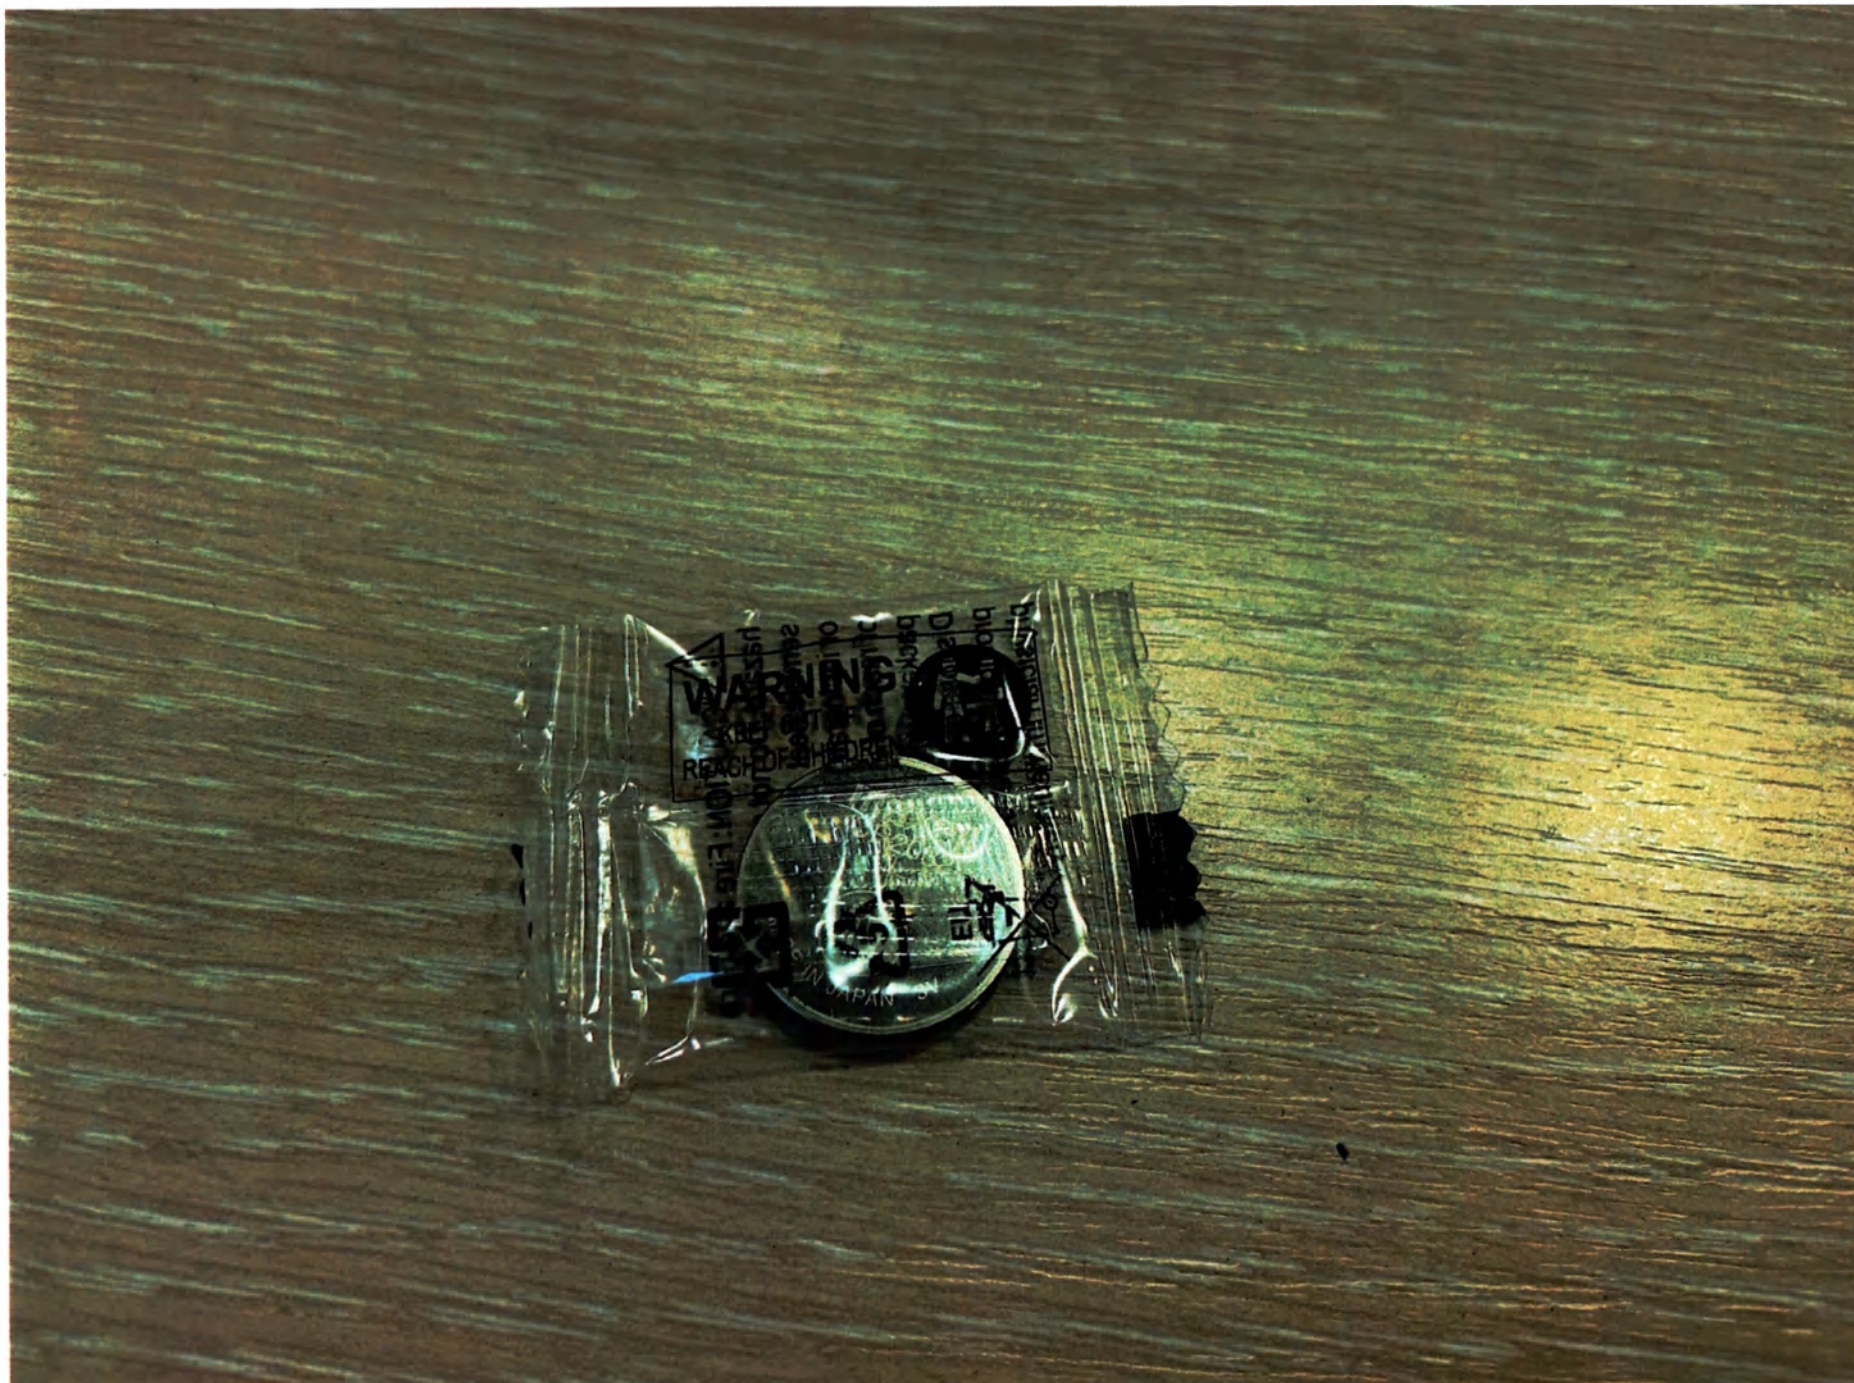

6. Футляр





Краткая процедура теста:



1. Вставьте тест-полоску в глюкометр.



2. Осуществите забор капли крови тест-полоской.



3. Подождите 5 секунд, результат измерения будет показан на экране глюкометра.



Внимание!

Нельзя наносить каплю крови сверху на тест-полоску. Это приводит к неверным результатам измерения!



Поднесите тест-полоску к капле крови верхним торцом для обеспечения полного заполнения капиллярного канала!

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont», в составе:
1. Глюкометр Diacont - 1 шт.
2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diacont, производства OK Biotech Co., Ltd., РУ № ФСЗ 2012/06698 - 1 шт.*
3. Скарifierатор Diacont в комплекте со стерильными ланцетами производства OK Biotech Co., Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 - 1 шт.*
4. Контрольный раствор нормальной концентрации - 1 шт. (при необходимости)**
5. Контрольный раствор высокой концентрации - 1 шт. (при необходимости)**
6. Батарея CR2032 - 1 шт.
7. Футляр - 1 шт.
8. Инструкция по использованию - 1 шт.

* Система комплектуется: Скарifierатор Diacont (1 шт.) в комплекте со стерильными ланцетами - 10 шт./уп.
** Система комплектуется одним вариантом исполнения контрольного раствора: НОРМАЛЬНЫЙ или ВЫСОКИЙ уровень, а также и без него. На упаковке системы указана информация о комплектности поставки.

Производитель:
«ОК Биотек Ко., Лтд», Тайвань,
OK Biotech Co., Ltd., No.91, Sec.2,
Gongdao 5th Road, 30070, Hsinchu City, Taiwan
Место производства:
OK Biotech Co., Ltd., No.91, Sec.2,
Gongdao 5th Road, 30070, Hsinchu City, Taiwan
Уполномоченный представитель
производителя в России: ООО «Диаконт»
Россия, 125284, Москва,
ул. Беговая, д. 13, кв. 90

Горячая линия ООО «Диаконт»:
8 (800) 775-05-41 (звонок бесплатный)
Информация о продукции на сайте:
www.diacont.ru



По вопросам работы глюкометра обращайтесь в сервисный центр «Diacont» по номеру телефона горячей линии: 8 (800) 775-05-41, звонок по России бесплатный.

**СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ МАРКИ
«Diacont»**

- ✓ точный результат за 5 секунд
- ✓ маленькая капля крови 0.7 мкл
- ✓ не требует ввода кода



ТОЧНО И ПРОСТО



Для IN VITRO диагностики

ВНИМАНИЕ!

- Для самостоятельного количественного измерения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови.
- Внимательно прочитайте инструкцию по использованию к системе перед началом работы.
- Не используйте тест-полоски после окончания их срока годности.
- Не используйте тест-полоски повторно, не храните их в холодильнике или под прямыми лучами солнца.
- Храните систему при температуре от +4°C до +30°C при относительной влажности 10-85%.
- Глюкометр Diacont работает с тест-полосками Diacont.
- Кодирование глюкометра не требуется.

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12699 от XX.XX.XXXX г.

CE 0123 REF 30-20-5100-1020



4 712803 562598

10-62-9128-0020
V2-APR18





Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont»,
в составе:

1. Глюкометр Diascont - 1 шт.

SN



2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diascont, производства OK Biotech Co., Ltd.,
РУ № ФСЗ 2012/12700 - 10 шт./уп.

LOT



3. Скарификатор Diascont в комплекте со стерильными ланцетами,
производства OK Biotech Co., Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 - 1 шт.

LOT



4. Контрольный раствор нормальной концентрации - 1 шт.

LOT



5. Батарейка CR2032 - 1 шт.

6. Футляр - 1 шт.

7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.



Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont»,
в составе:

1. Глюкометр Diascont – 1 шт.

SN



2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diascont, производства OK Biotech Co., Ltd.,
РУ № ФСЗ 2012/12700 – 10 шт./уп.

LOT



3. Схарификатор Diascont в комплекте со стерильными ланцетами,
производства OK Biotech Co., Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT



4. Контрольный раствор высокой концентрации – 1 шт.

LOT



5. Батарейка CR2032 – 1 шт.

6. Футляр – 1 шт.

7. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont»,
в составе:

1. Глюкометр Diascont – 1 шт.

SN



2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант
исполнения Diascont, производства OK Biotech Co., Ltd.,
РУ № ФСЗ 2012/12700 – 10 шт./уп.

LOT



3. Скарификатор Diascont в комплекте со стерильными ланцетами,
производства OK Biotech Co., Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT




4. Батарейка CR2032 – 1 шт.

5. Футляр – 1 шт.

6. Инструкция по использованию – 1 шт.

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Compact в составе:


1. Глюкометр Diacont Compact

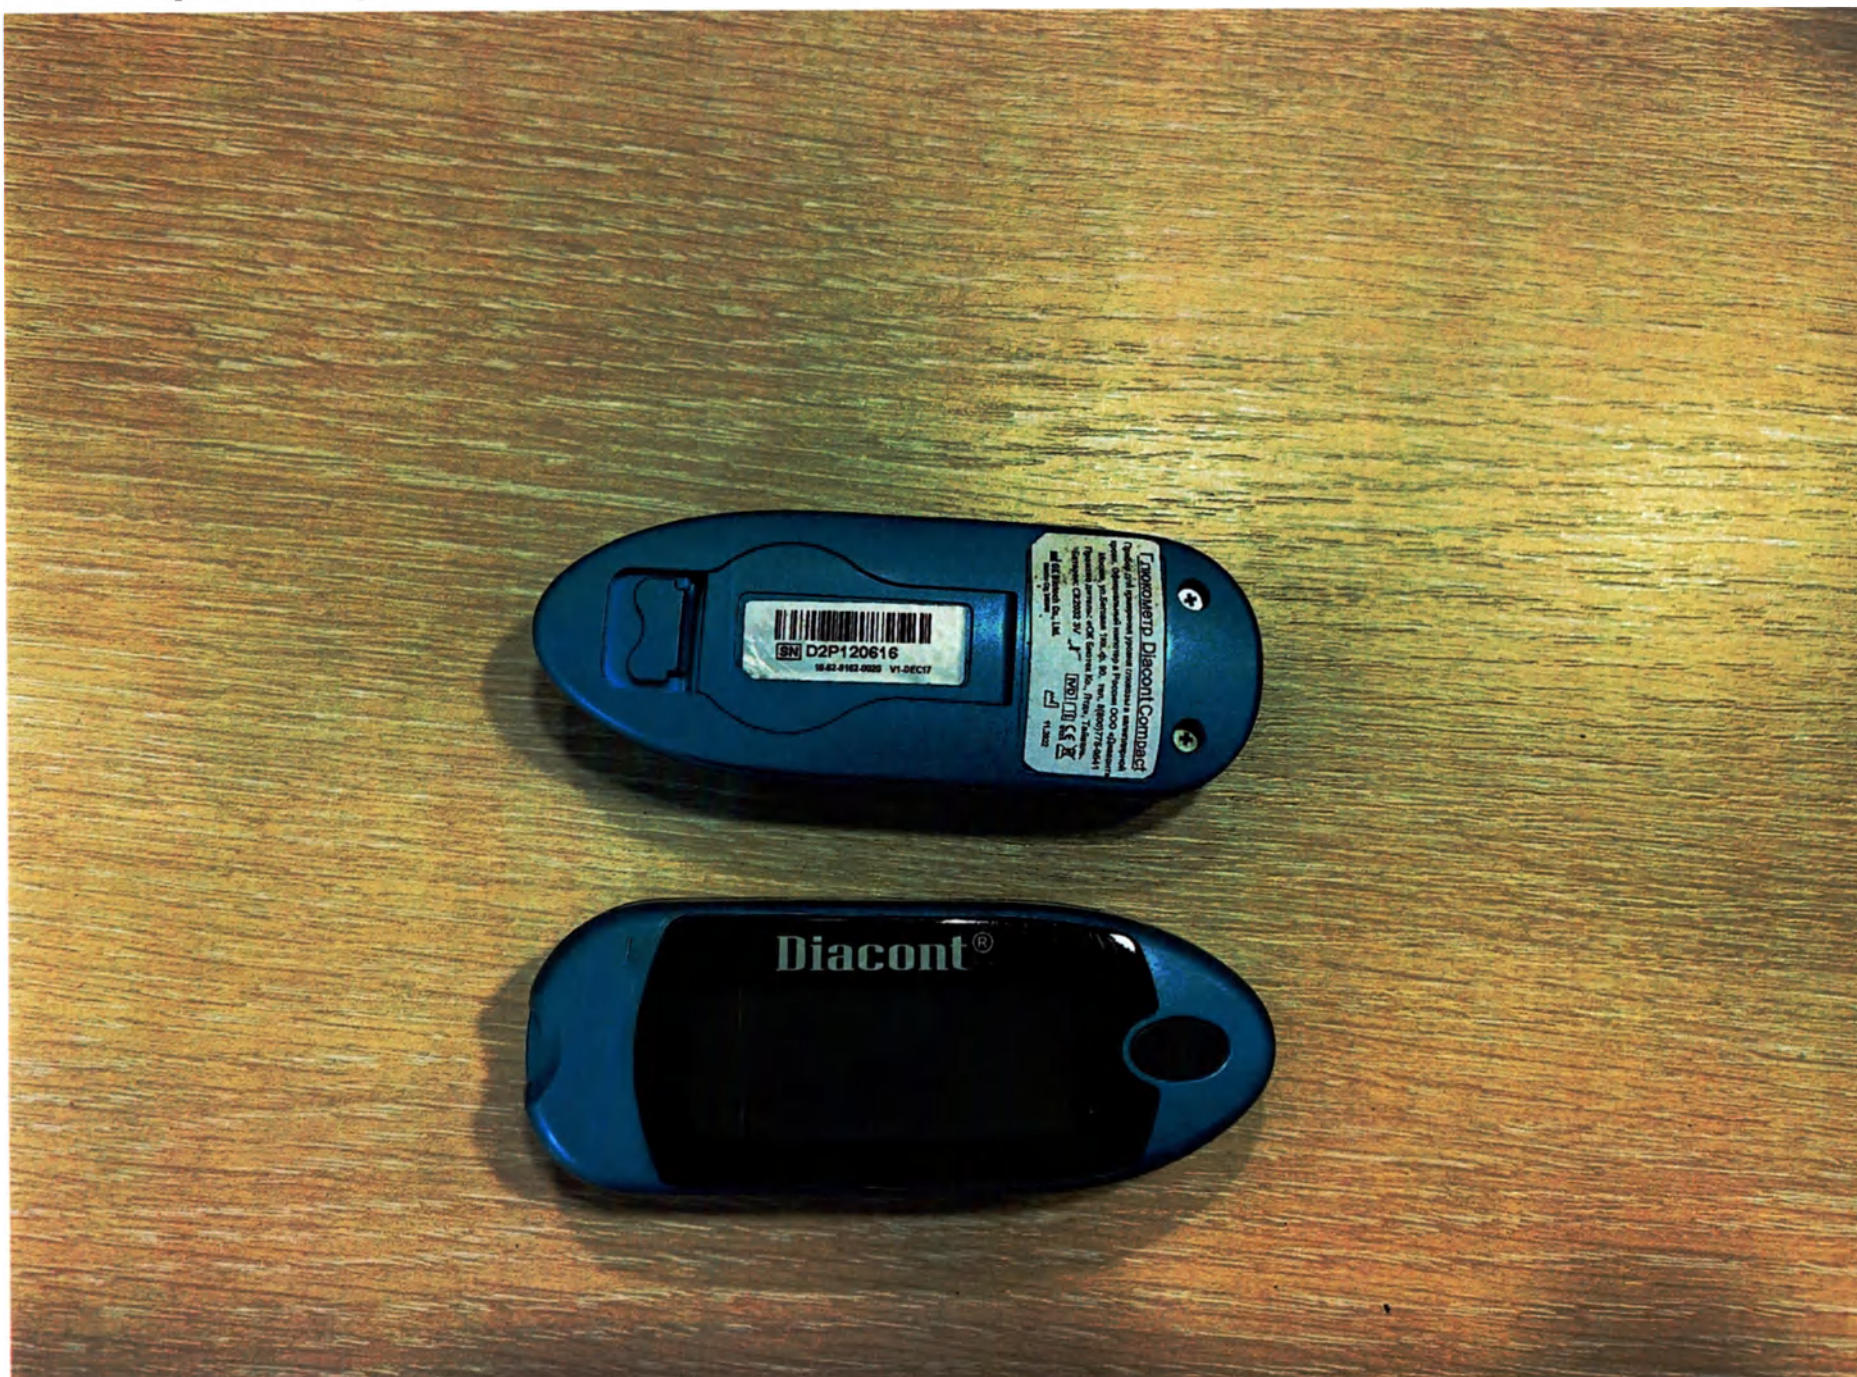

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Compact в составе:

17

2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diacont, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2012/12700

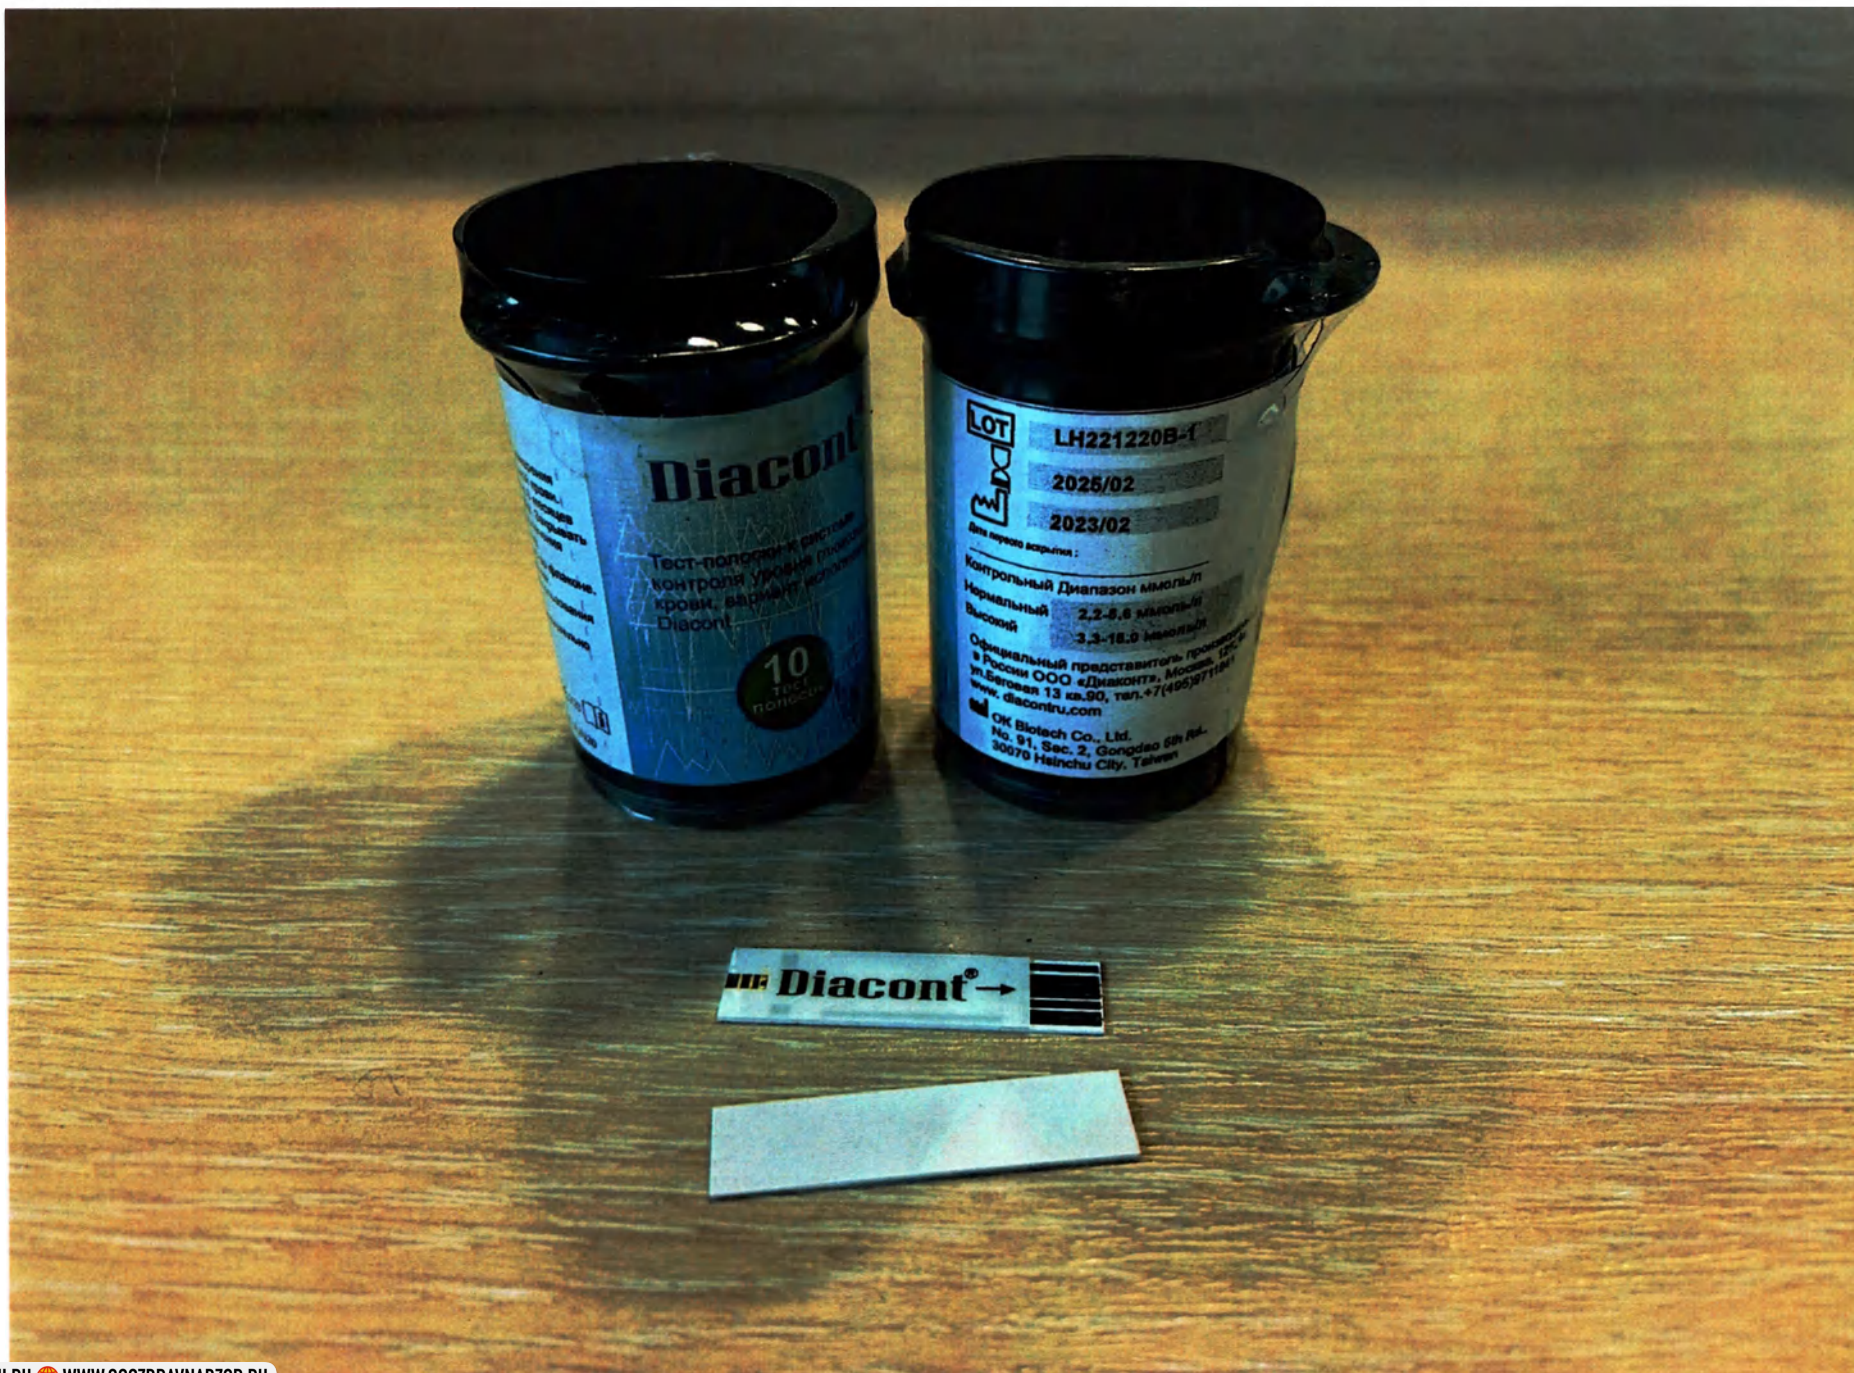


3. Скарификатор Diascont в комплекте со стерильными ланцетами, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698




4. Контрольный раствор нормальной концентрации





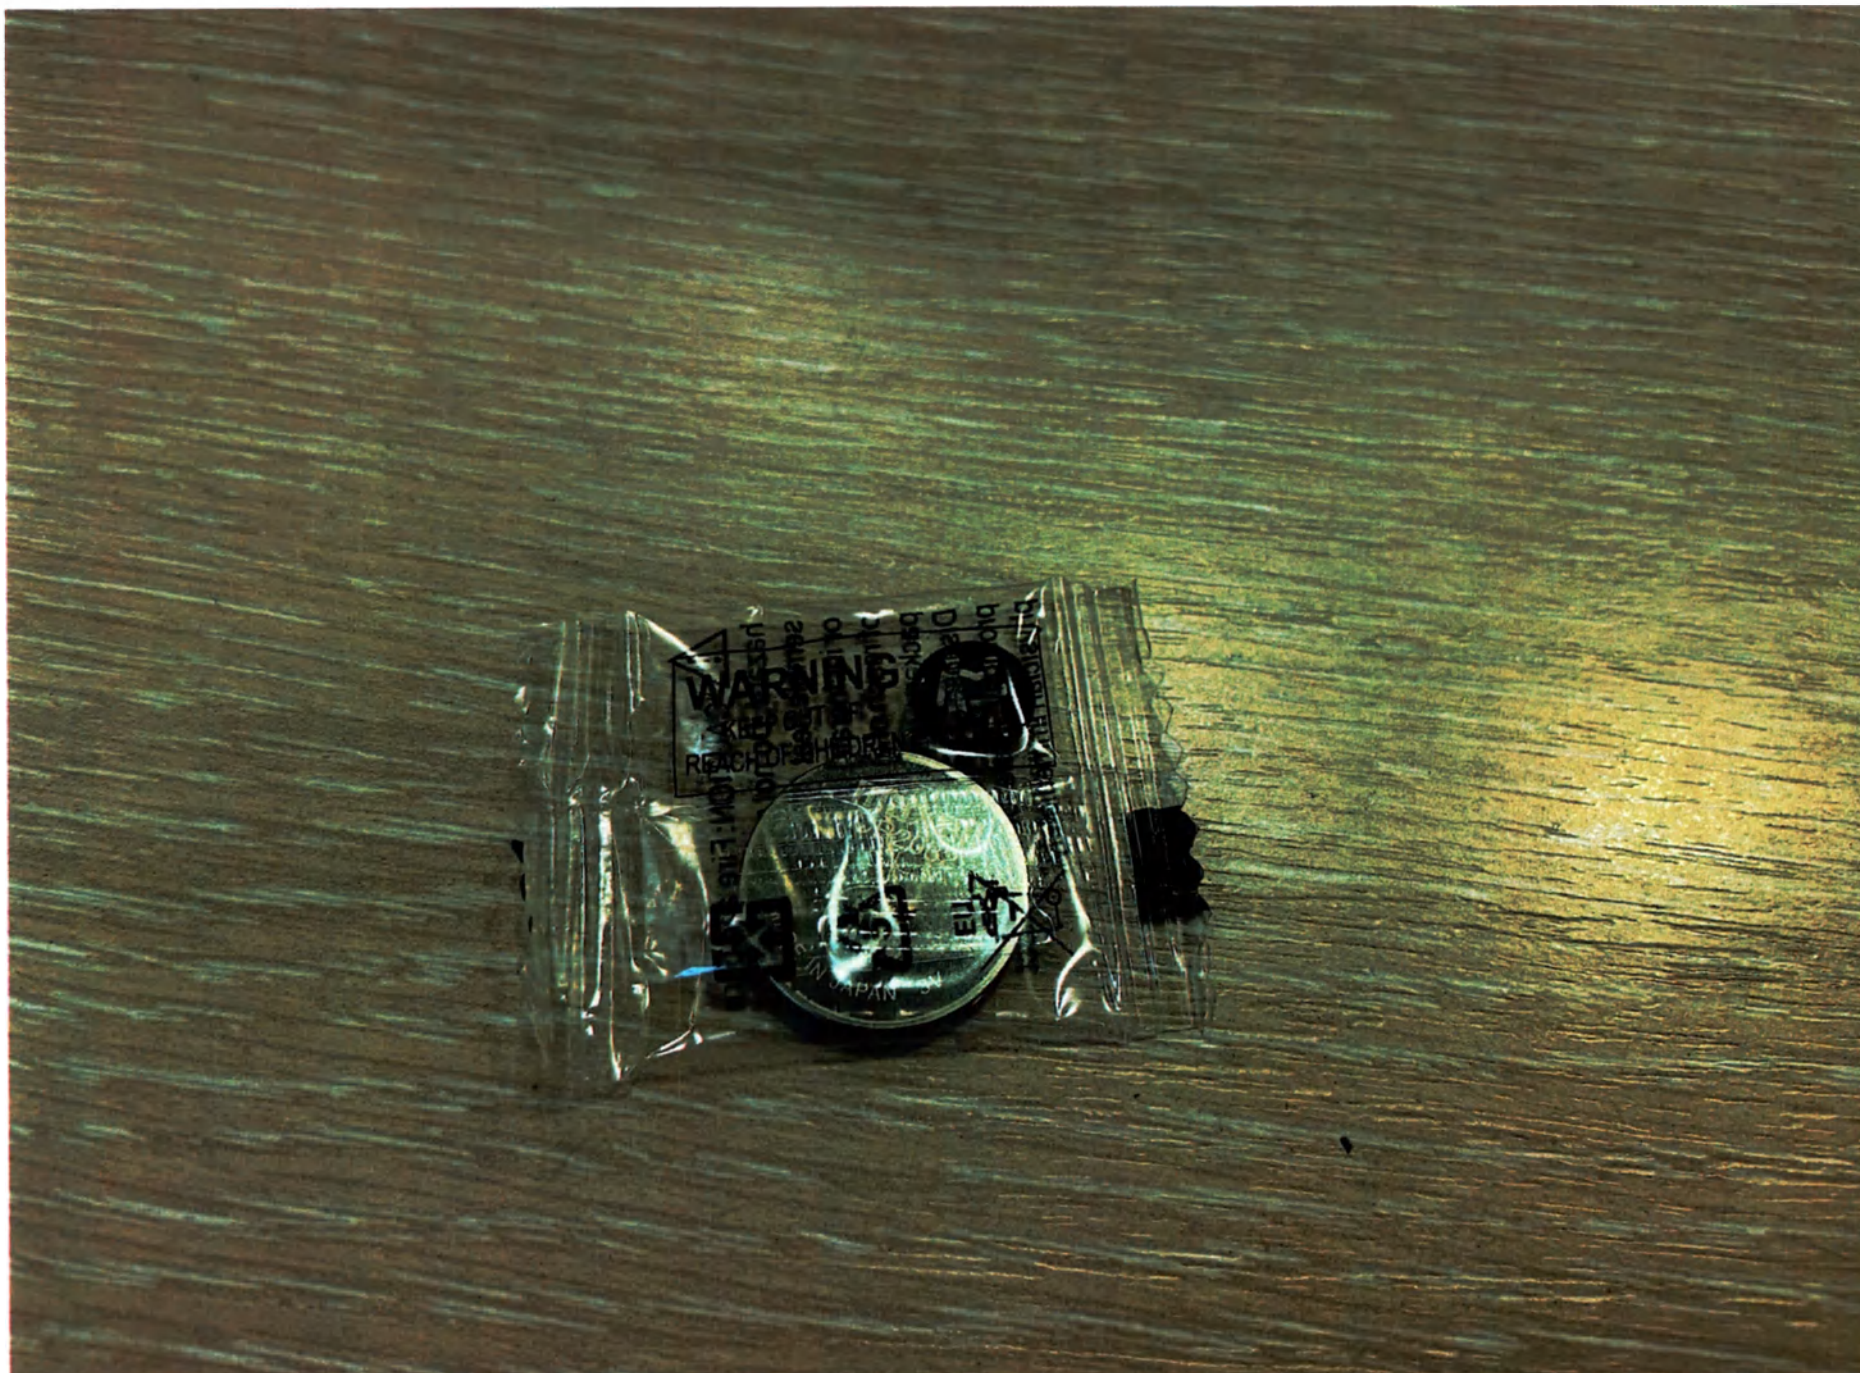



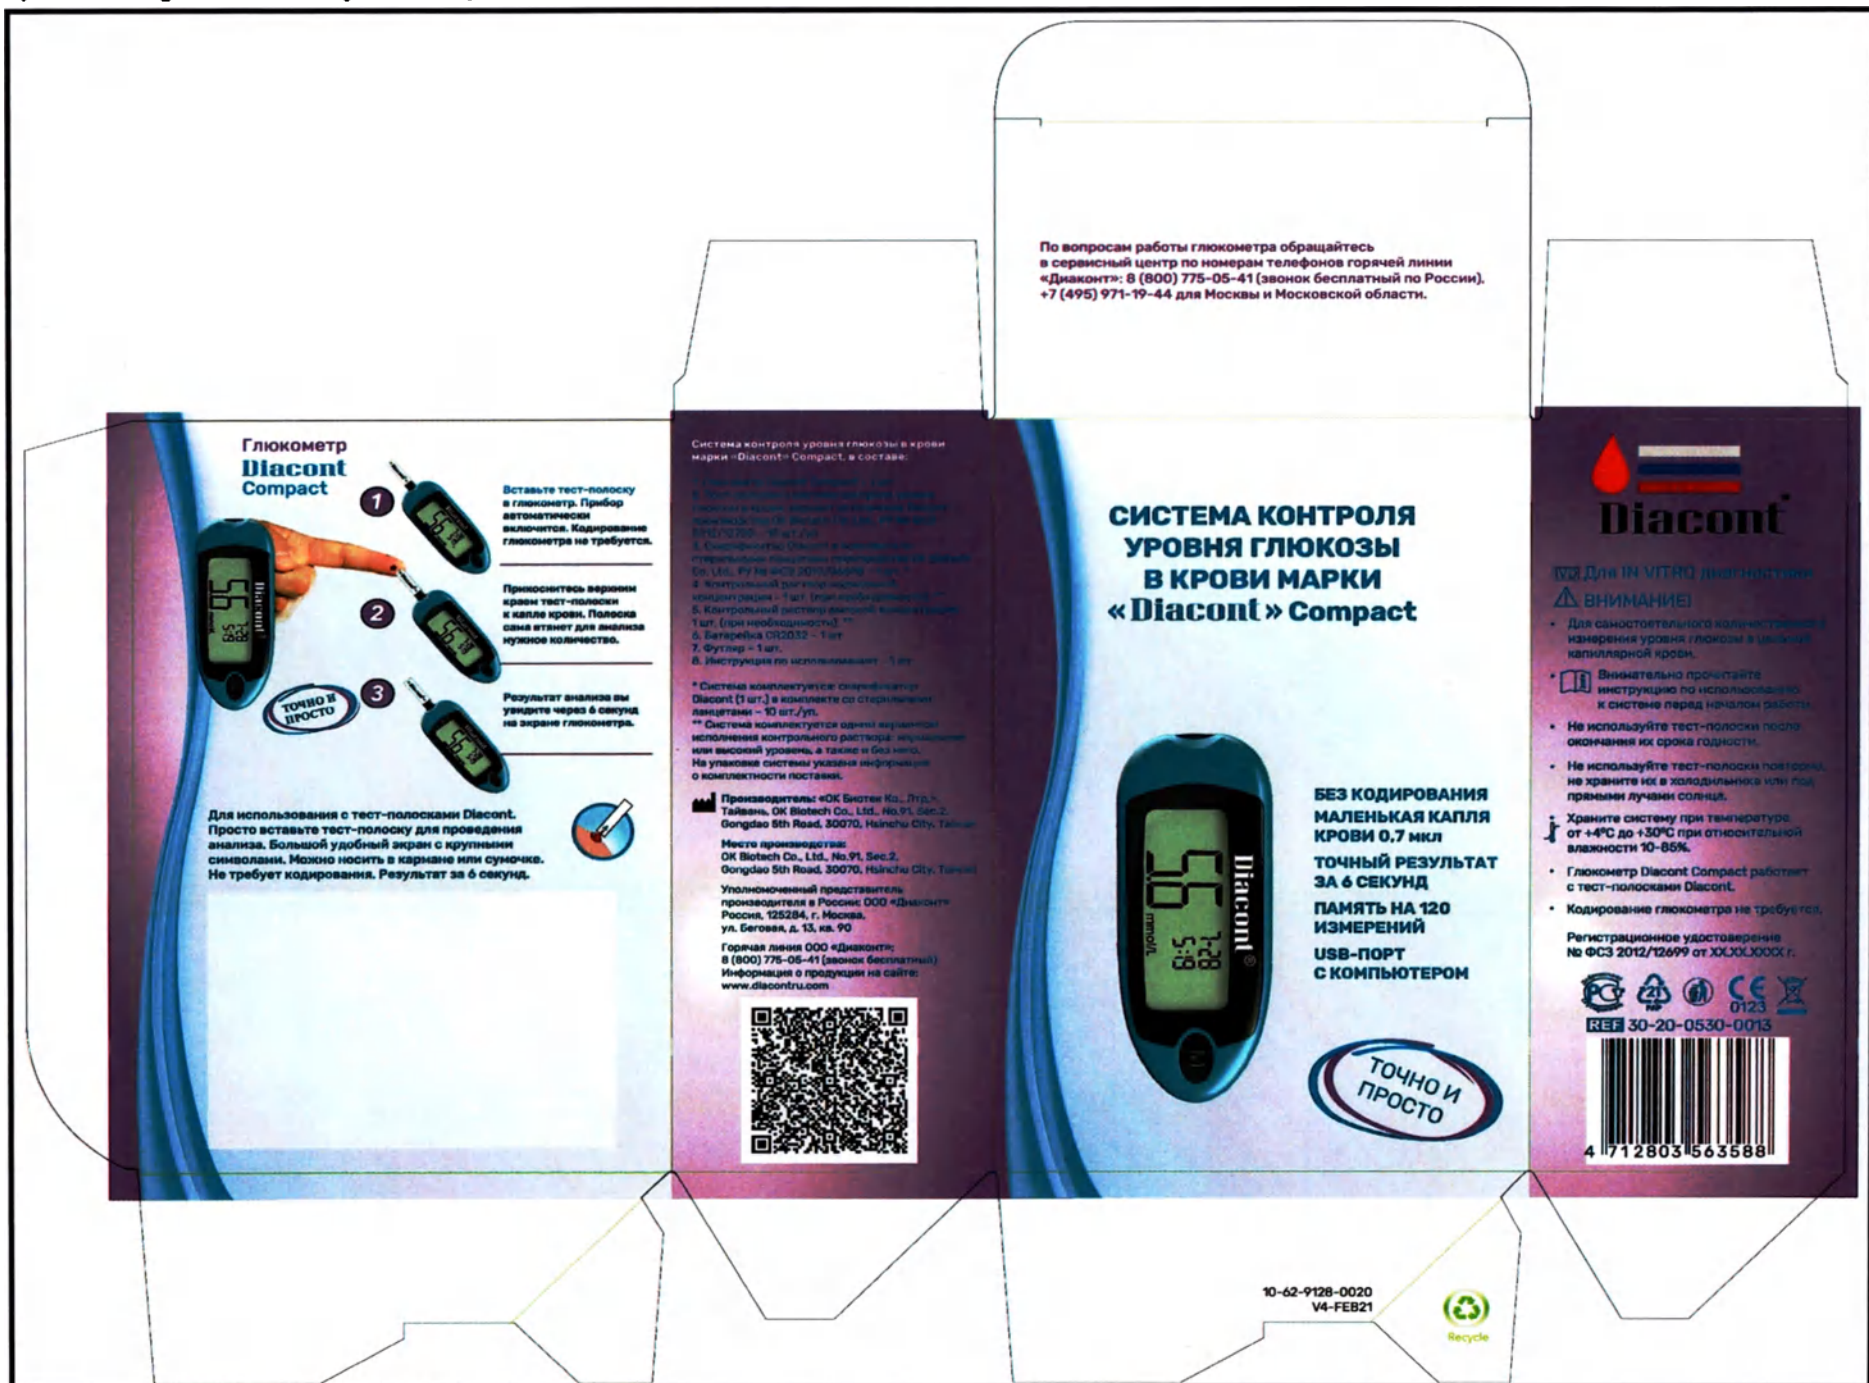

Общий вид Системы контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Compact в комплектации с контрольным раствором нормальной 24 концентрации



Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Compact, в составе:

1. Глюкометр Diacont Compact – 1 шт.

SN



2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diacont, производства OK Biotech Co. Ltd.,
РУ № ФСЗ 2012/12700 – 10 шт./уп.

LOT



3. Скарификатор Diacont в комплекте со стерильными ланцетами,
производства OK Biotech Co. Ltd.,
РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT



4. Контрольный раствор нормальной концентрации – 1 шт.

LOT



5. Батарейка CR2032 – 1 шт.

6. Футляр – 1 шт.

7. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont» Compact, в составе:

1. Глюкометр Diascont Compact – 1 шт.

SN



2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diascont, производства OK Biotech Co. Ltd.,
РУ № ФСЗ 2012/12700 – 10 шт./уп.

LOT



3. Скарификатор Diascont в комплекте со стерильными ланцетами,
производства OK Biotech Co. Ltd.,
РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT



4. Контрольный раствор высокой концентрации – 1 шт.

LOT



5. Батарейка CR2032 – 1 шт.

6. Футляр – 1 шт.

7. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови марки
«Diascont» Compact, в составе:

1. Глюкометр Diascont Compact – 1 шт.

SN



2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант
исполнения Diascont, производства OK Biotech Co. Ltd.,
РУ № ФСЗ 2012/12700 – 10 шт./уп.

LOT



3. Скарификатор Diascont в комплекте со стерильными ланцетами,
производства OK Biotech Co. Ltd.,
РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT



4. Батарейка CR2032 – 1 шт.

5. Футляр – 1 шт.

6. Инструкция по использованию – 1 шт.

1. Глюкометр Diacont Connect



Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Connect в составе:

31

2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diacont, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2012/12700



Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont» Connect в составе:

3. Скарификатор Diascont в комплекте со стерильными ланцетами, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698




4. Контрольный раствор нормальной концентрации





6. Батарейка CR2032

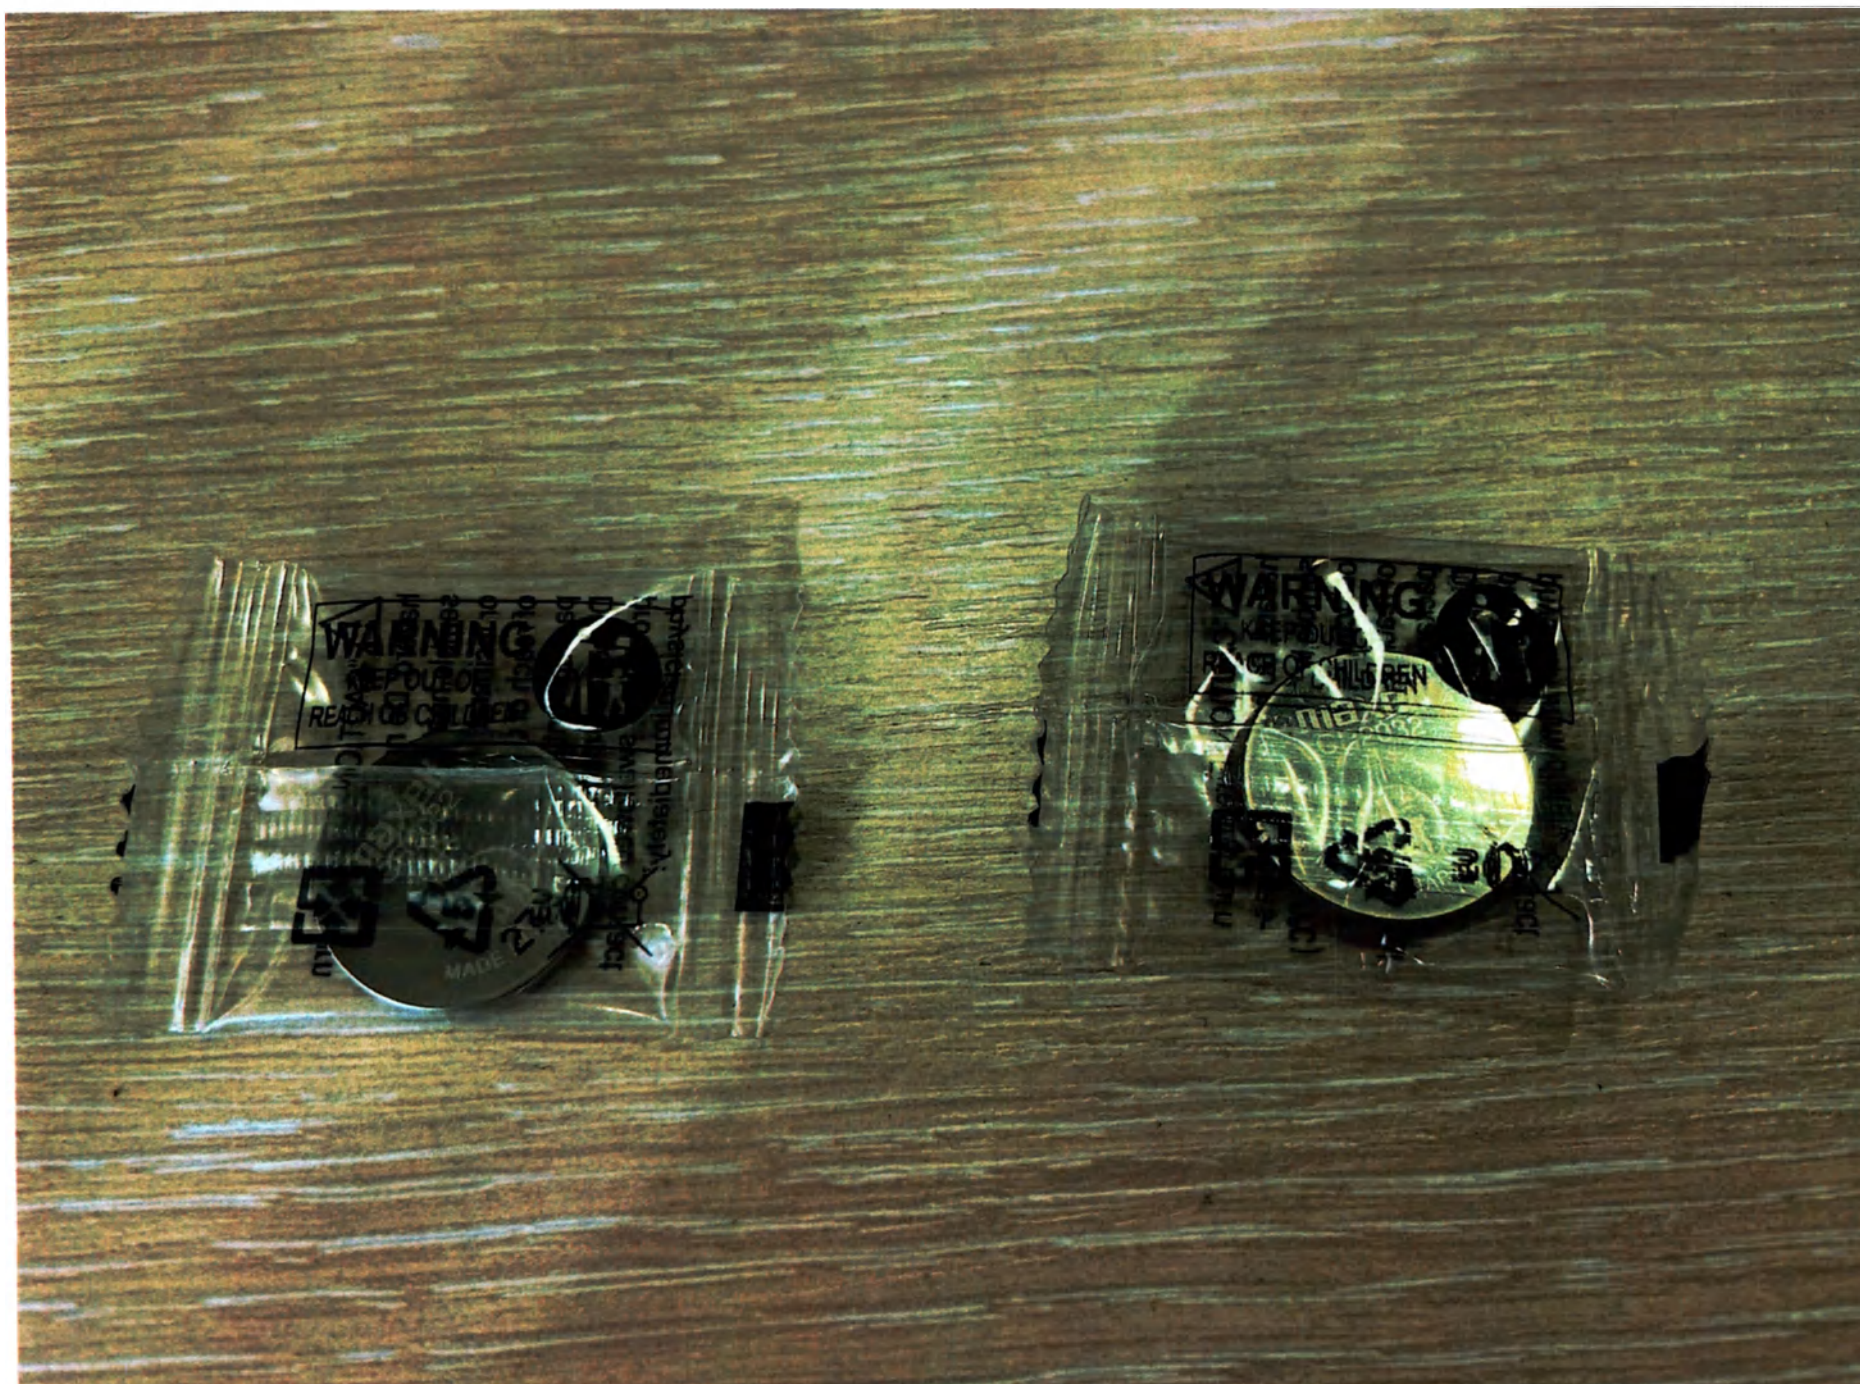


7. Футляр



Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Connect в составе:

8. Программное мобильное приложение Diacont Connect для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета.

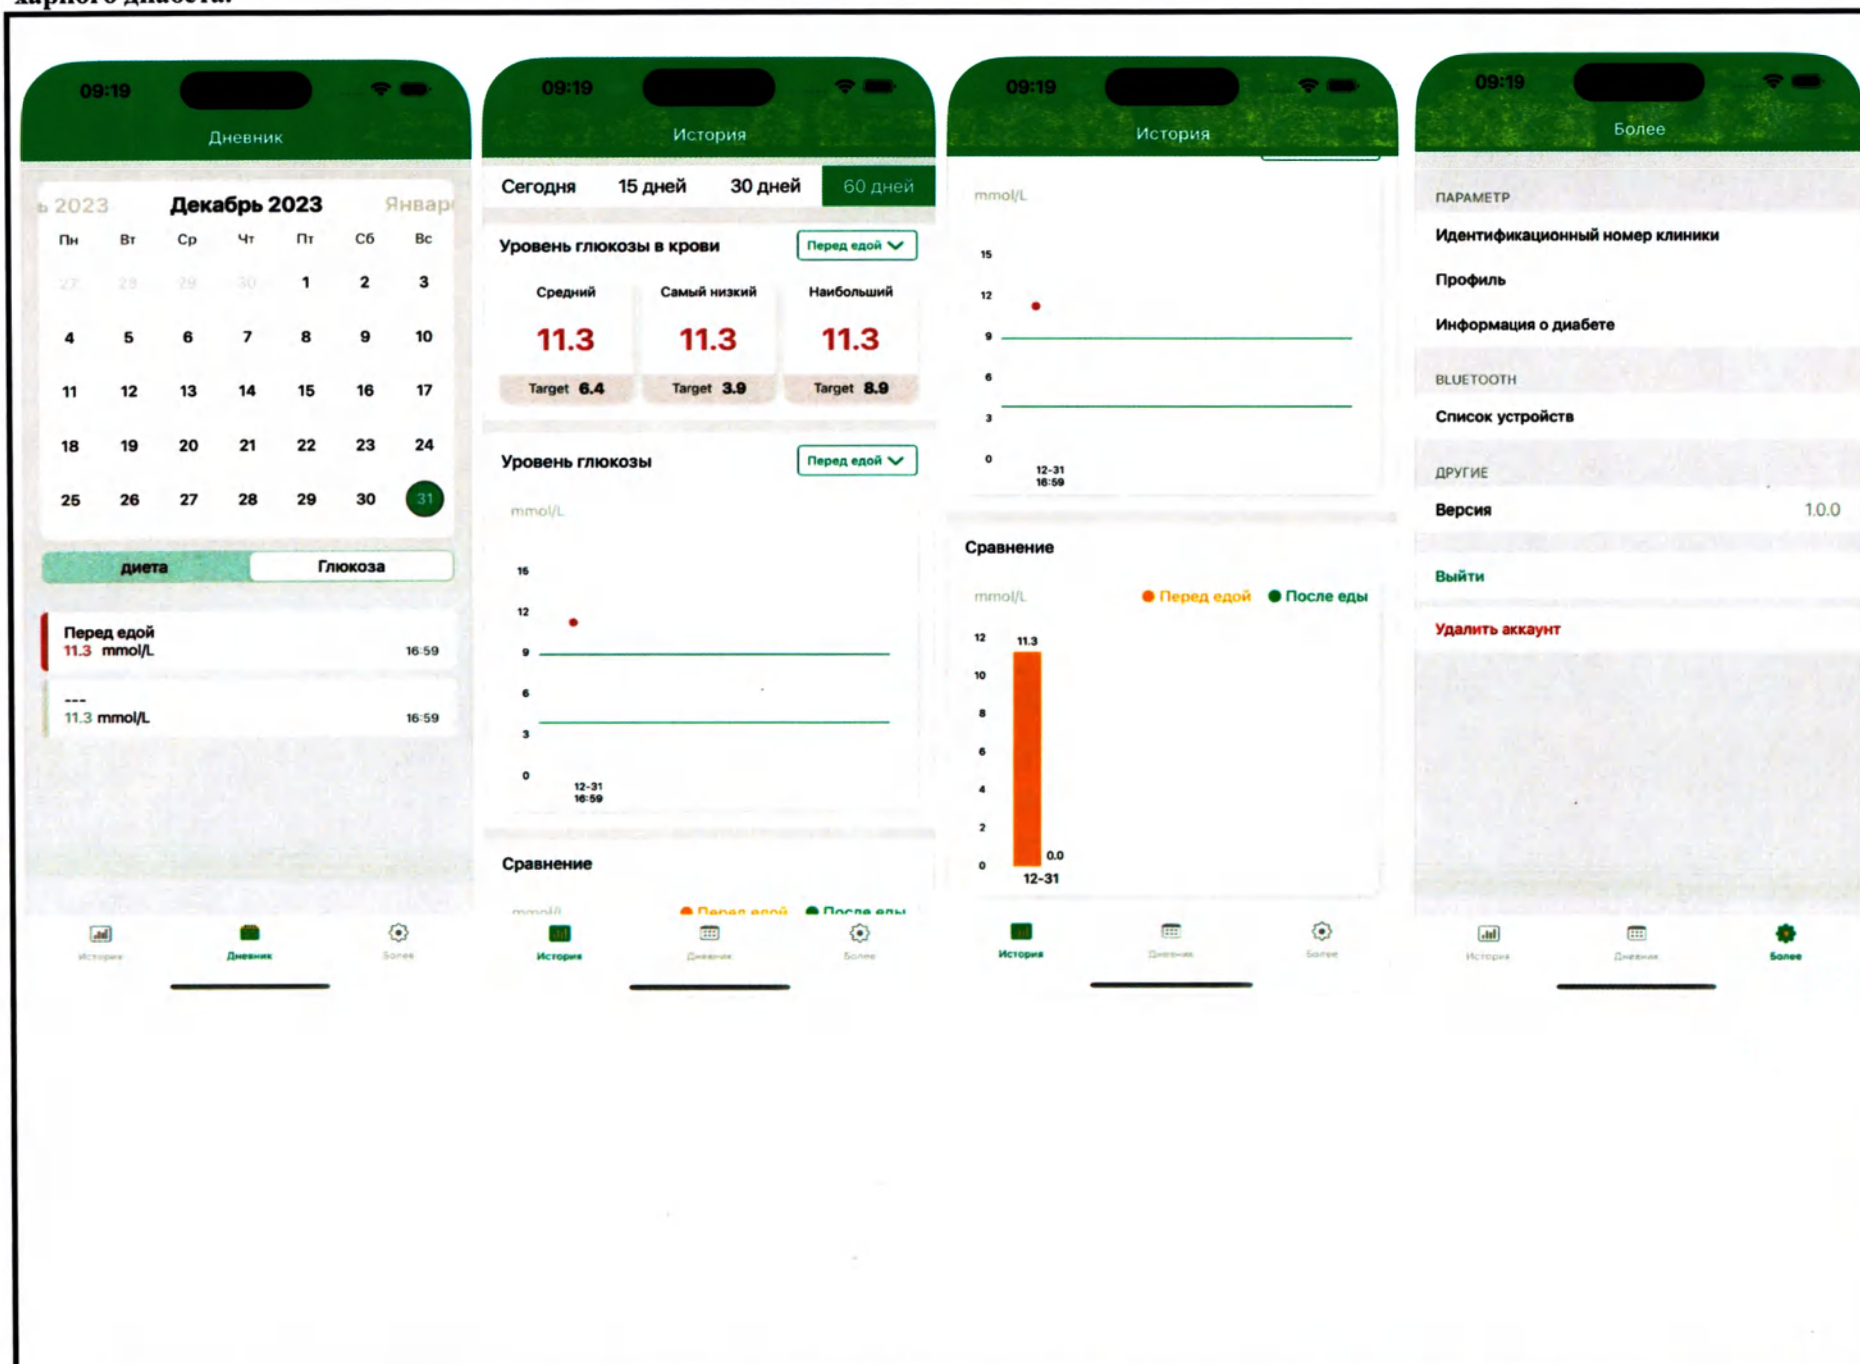





Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont» Connect, в составе:

1. Глюкометр Diascont Connect – 1 шт.

SN



2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diascont, производства OK Biotech Co., Ltd.,
РУ № ФСЗ 2012/12700 – 10 шт./уп.

LOT



3. Скарификатор Diascont в комплекте со стерильными ланцетами,
производства OK Biotech Co., Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT



4. Контрольный раствор нормальной концентрации – 1 шт.

LOT



5. Батарейка CR2032 – 2 шт.

6. Футляр – 1 шт.

7. Инструкция по использованию – 1 шт.

Программное мобильное приложение Diascont Connect для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета доступно для скачивания в онлайн-магазинах App Store или Google Play.



Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont» Connect, в составе:

1. Глюкометр Diascont Connect – 1 шт.

SN



2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diascont, производства OK Biotech Co., Ltd.,
РУ № ФСЗ 2012/12700 – 10 шт./уп.

LOT



3. Схрификатор Diascont в комплекте со стерильными ланцетами,
производства OK Biotech Co., Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT



4. Контрольный раствор высокой концентрации – 1 шт.

LOT



5. Батарейка CR2032 – 2 шт.

6. Футляр – 1 шт.

7. Инструкция по использованию – 1 шт.

Програмное мобильное приложение Diascont Connect для мониторинга показаний уровня глюкозы в режиме самонаблюдения при лечении сахарного диабета доступно для скачивания в онлайн-магазинах App Store или Google Play.



Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont» Connect, в составе:

1. Глюкометр Diascont Connect – 1 шт.

SN



2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diascont, производства OK Biotech Co., Ltd.
РУ № ФСЗ 2012/12700 – 10 шт./уп.

LOT



3. Скарификатор Diascont в комплекте со стерильными ланцетами, производства OK Biotech Co., Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT



4. Батарейка CR2032 – 2 шт.

5. Футляр – 1 шт.

6. Инструкция по использованию – 1 шт.

Програмное мобильное приложение Diascont Connect для мониторинга показателей уровня глюкозы в крови
самостоятельно при наличии интернет-доступа доступно для скачивания в онлайн-магазинах App Store или
Google Play.

Пример общего вида транспортной упаковки



Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Connect



REF 30-20-5100-1420



 OK Biotech Co., Ltd.
No. 91, Sec. 2, Gongdao 5th Road,
30070, Hsinchu City, Taiwan

Место производства:
OK Biotech Co., Ltd.
No. 91, Sec. 2, Gongdao 5th Road,
30070, Hsinchu City, Taiwan

Уполномоченный представитель в России:
ООО «Диаконт», Россия, 125284,
г. Москва, ул. Беговая, д. 13, кв. 90
тел.: 8 (800) 775-05-41

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____ г.

Diacont®	Уровень глюкозы	НОРМАЛЬНЫЙ	4 мл
		Дата вскрытия _____	
Контрольный раствор для глюкометров Diacont.		Использовать в течение 90 дней после первого вскрытия	
⚠ Не употреблять внутрь.		LOT	
IVD		+4°C	
		+30°C	
	CE 0123		OK Biotech Co. Ltd., No.91, Sec.2, Gongdao 5th Road 30070, Hsinchu City, Taiwan.
			
			

Diacont®	Уровень глюкозы	ВЫСОКИЙ	4 мл
		Дата вскрытия _____	
Контрольный раствор для глюкометров Diacont.		Использовать в течение 90 дней после первого вскрытия	
 Не употреблять внутрь.		LOT 	
 	+4°C  +30°C	 OK Biotech Co. Ltd., No.91, Sec.2, Gongdao 5th Road 30070, Hsinchu City, Taiwan.	 
CE 0123			

12

ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 48 л.



Чайко Н. И.