




Исход. № 180613/4 ОТ «18» июня 2013 г.
№ _____ ОТ «___» _____ 2013 г.

ФОТО
медицинского изделия и принадлежностей.


I. Анализатор лабораторный автоматический биохимический BA400

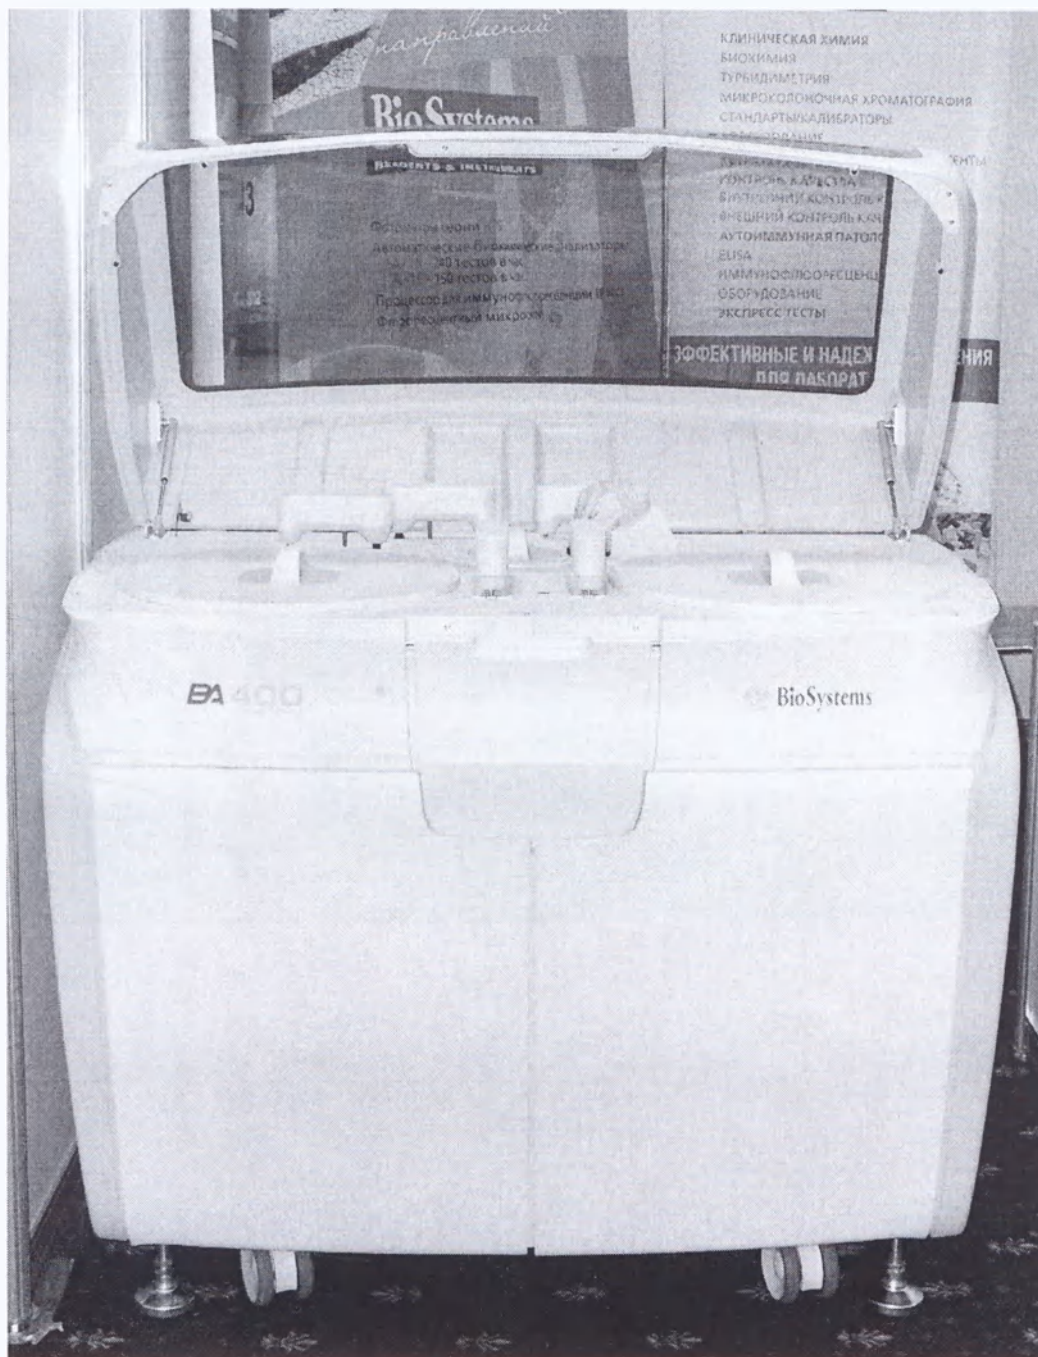

000 «МД-Консалтинг и Развитие» // MD-Consulting & Development Ltd.

Почтовый адрес: 115035 Москва, Овчинниковская набережная, д. 22/24, стр. 1 // Moscow, Russia, 115035 Ovchinnikovskaya emb., 22/24 build. 1
Телефон: +7 (495) 644-3376, Факс: +7 (499) 188-4728 // Phone: +7 (495) 644-3376, Fax: +7 (499) 188-4728
e-mail: info@obnovlenie.net

2. Педиатрические пробирки (1000 шт.).

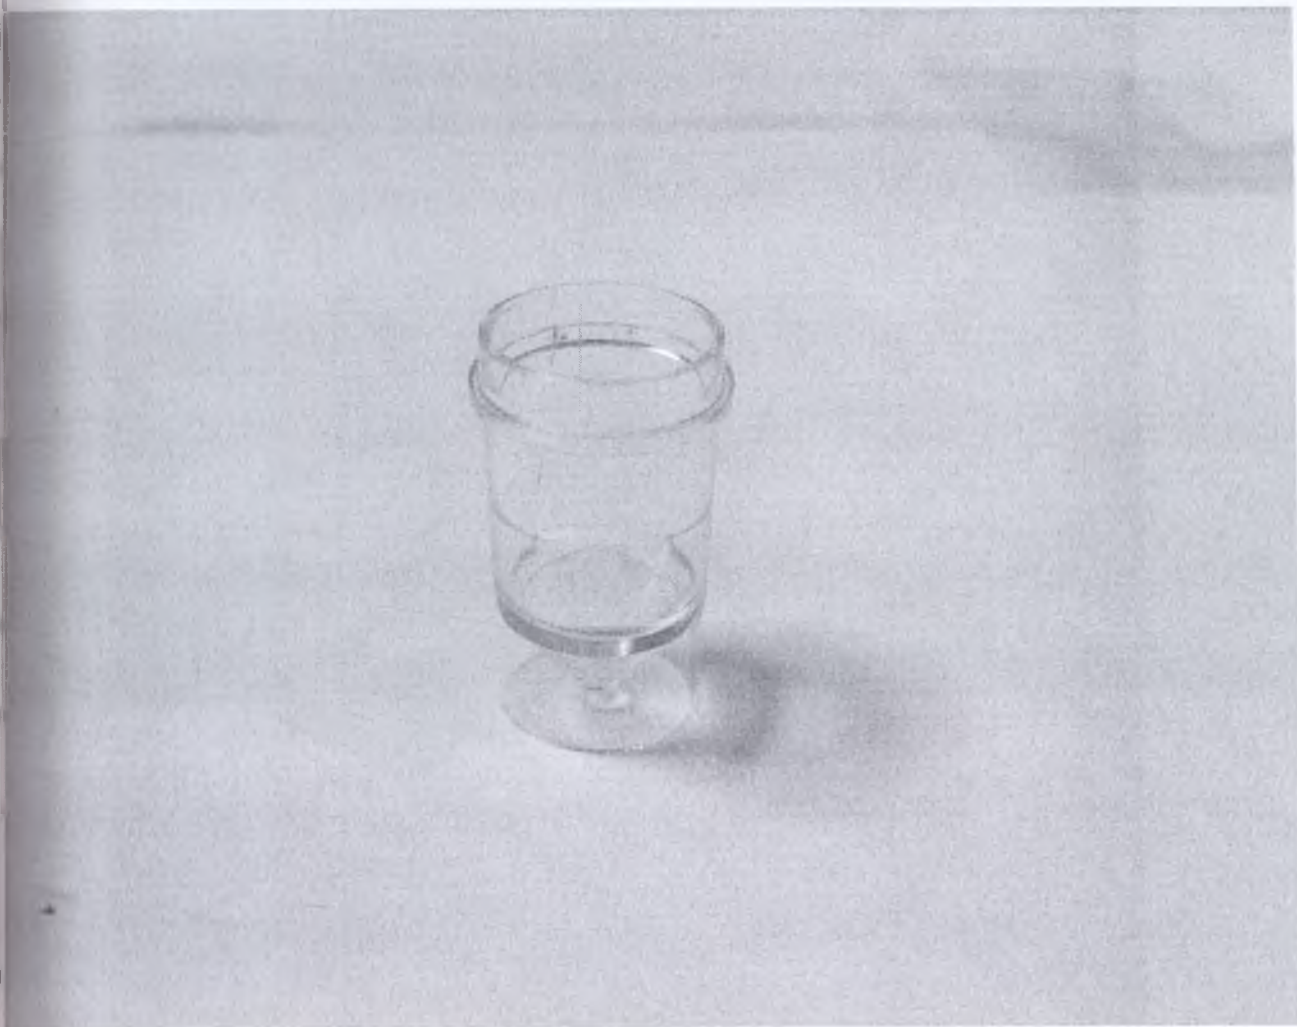


4. Адаптер для пробирок.




5. Адаптер для первичных пробирок.




6. Флаконы для реагентов 60 мл (30 шт).

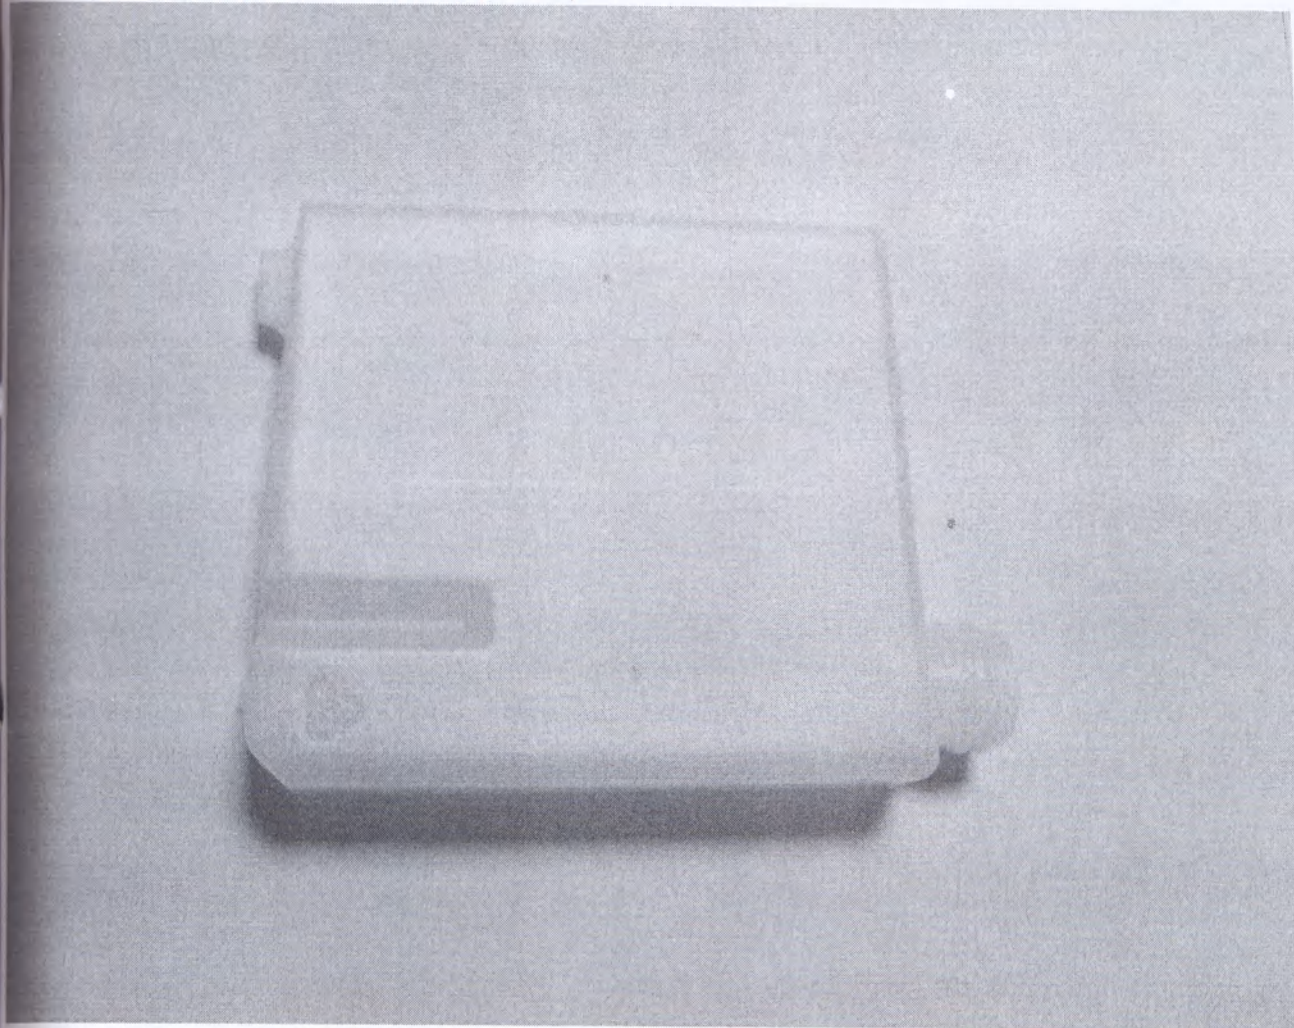



8. Ротор для реагентов.

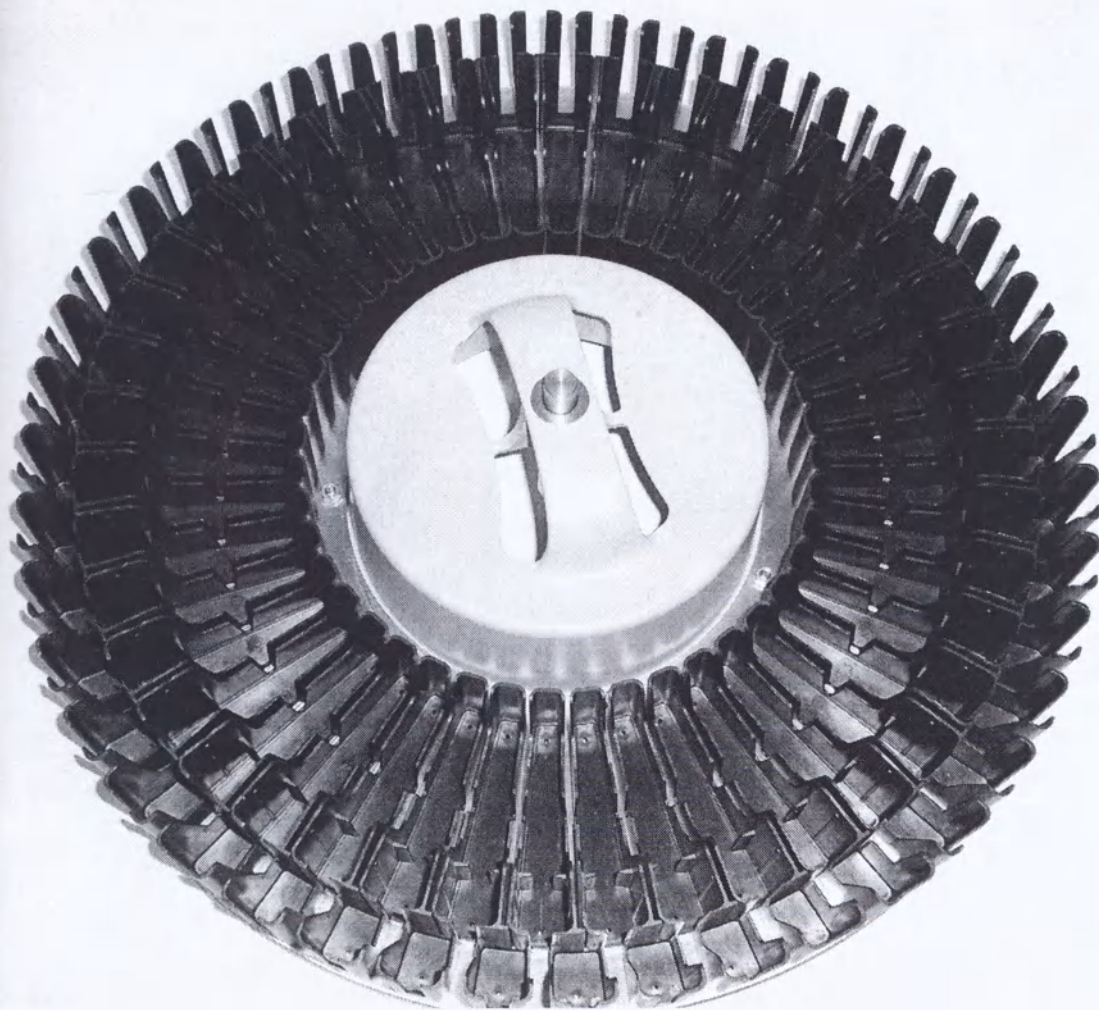

9. Ротор для проб.

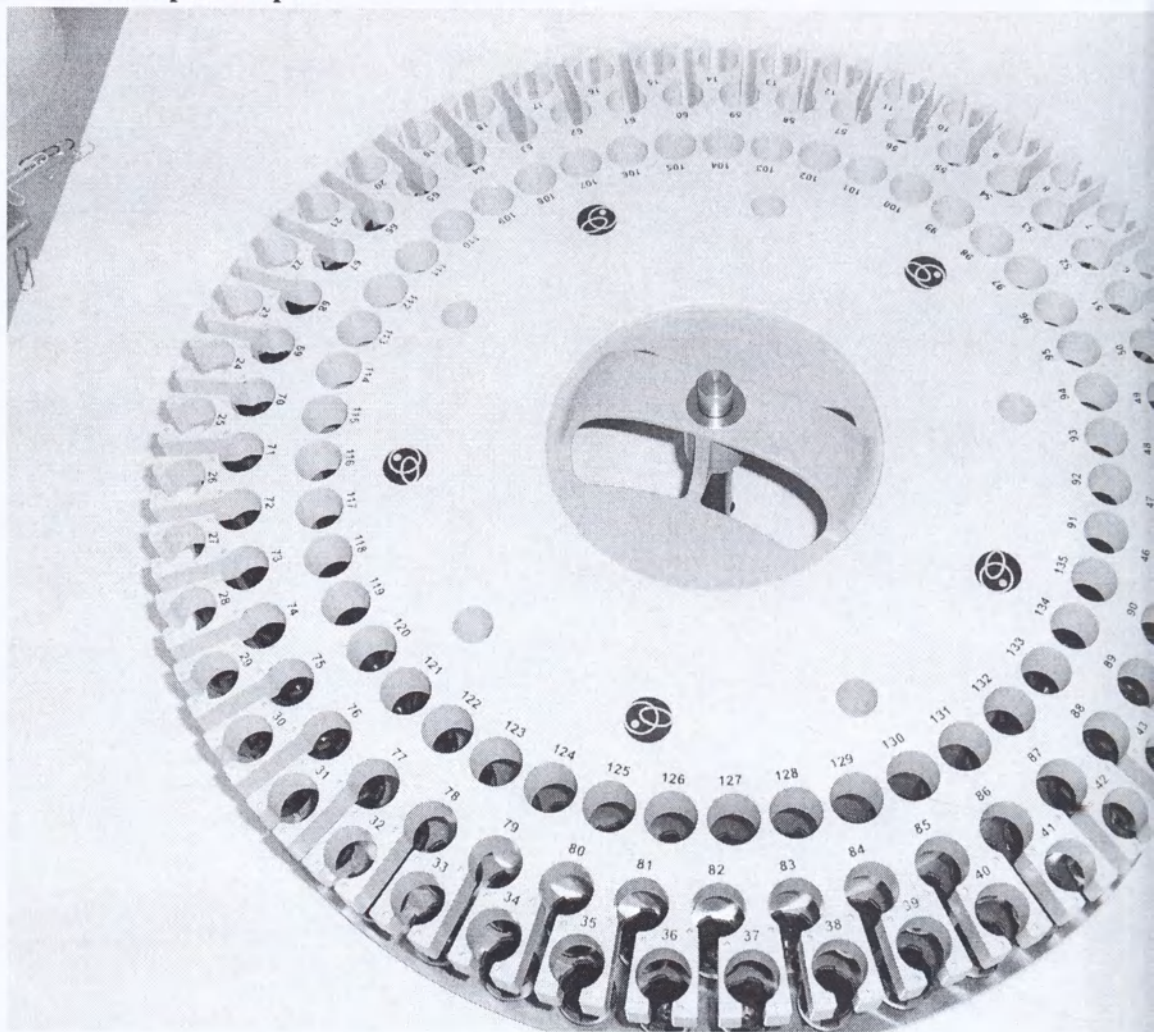


10. Соединительные трубки для воды: тонкая синяя трубка (3 м), толстая синяя трубка (3 м).

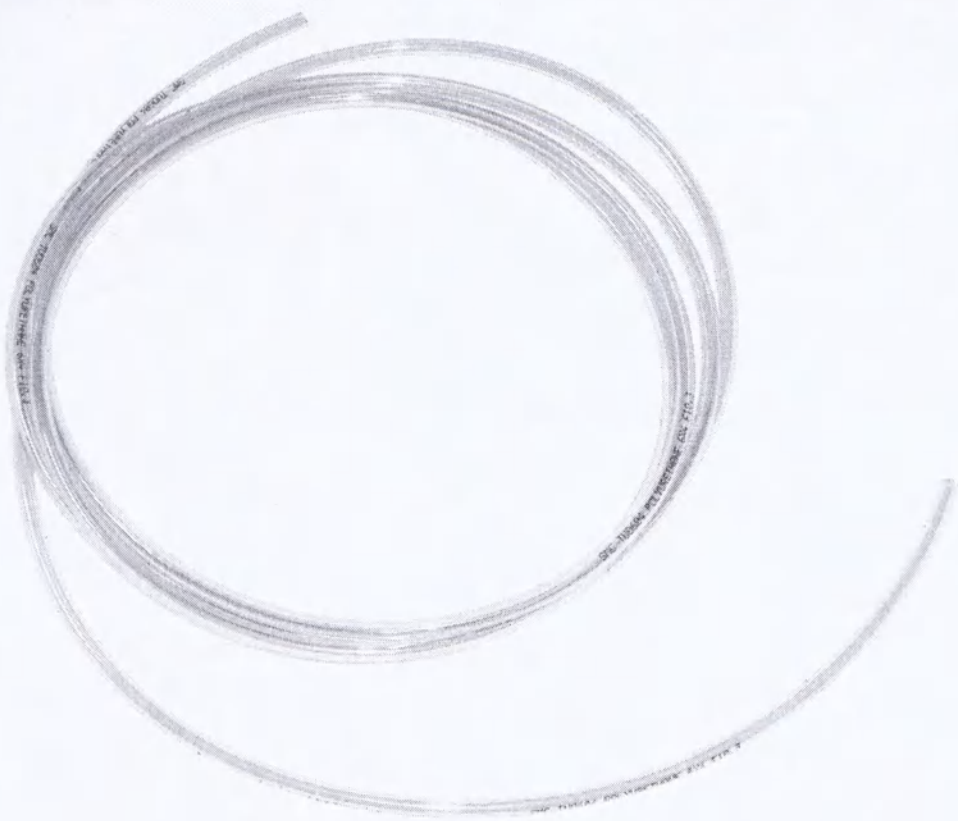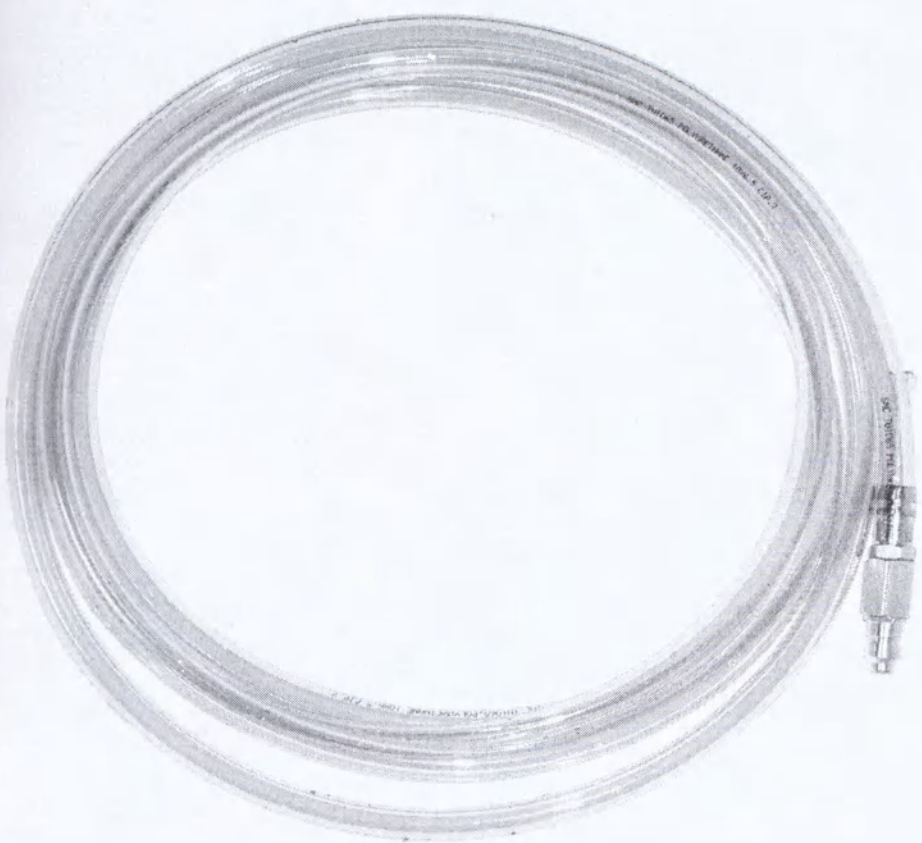

11. Соединительная трубка для отходов (3 м).




12. USB кабель.

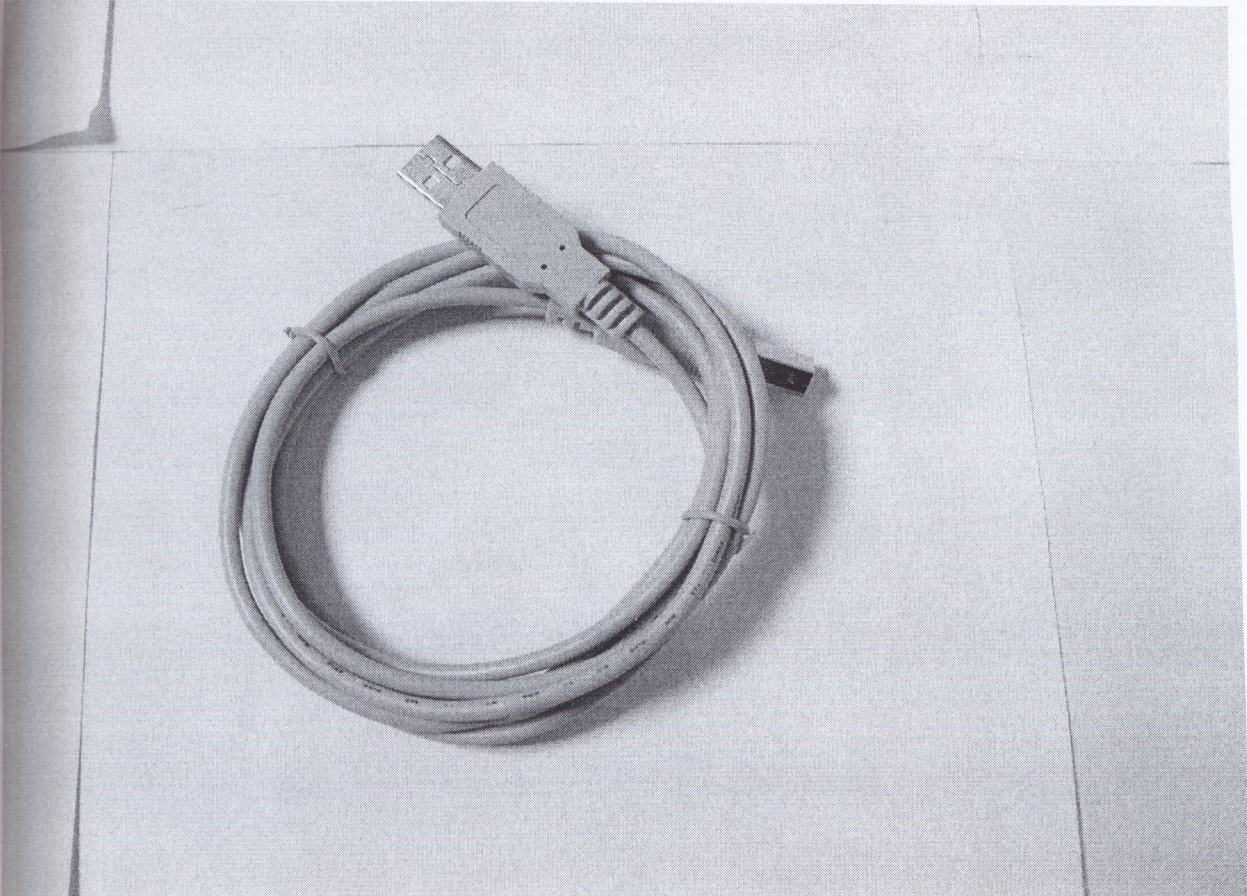

15. Наклейки для идентификации флаконов.




16. Предохранитель 10А.

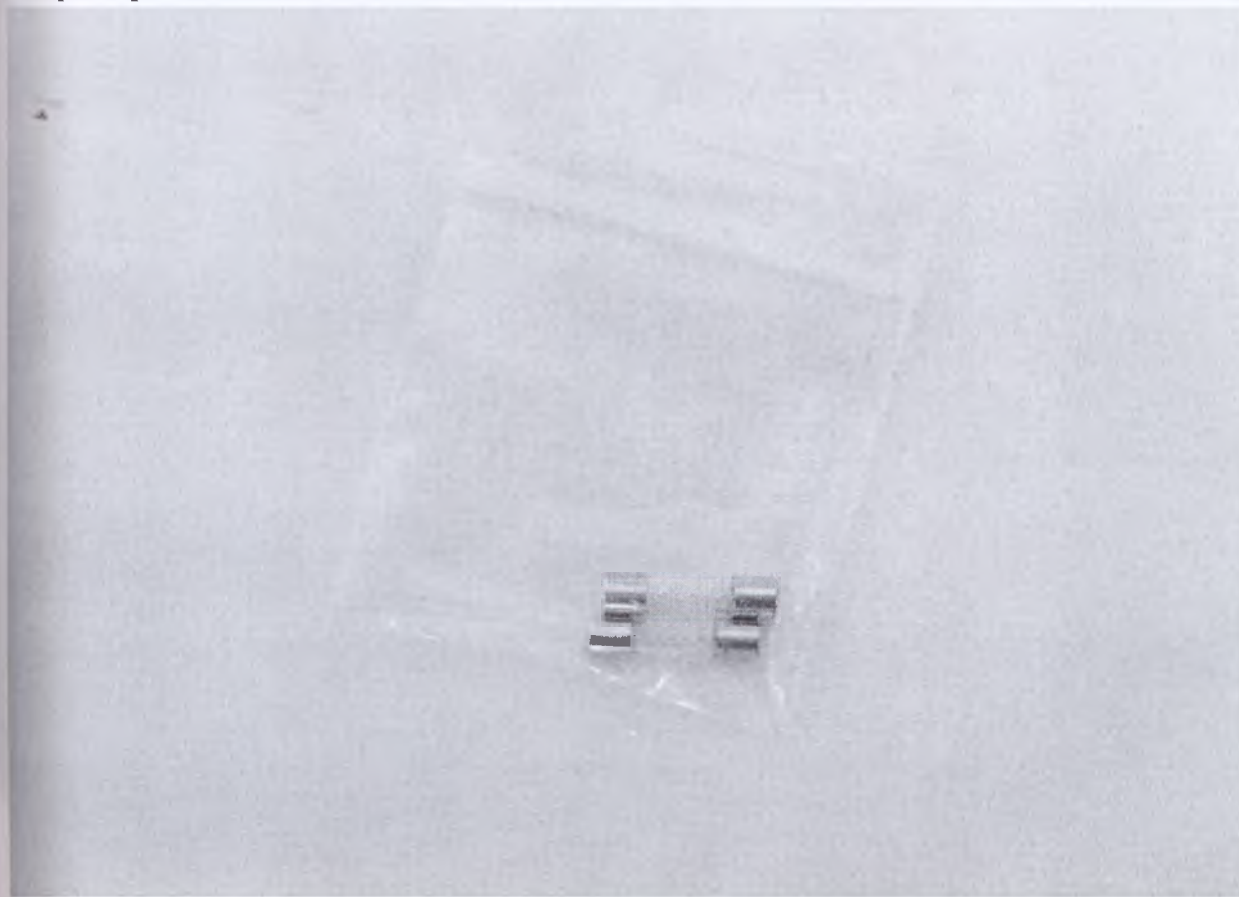


Принадлежности:

1. Натриевый (Na⁺) электрод – до 10 шт.

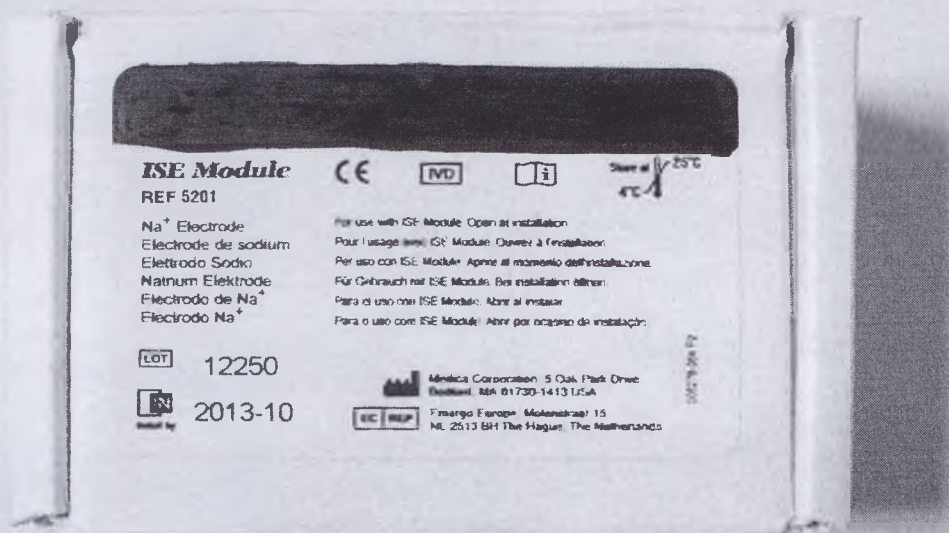

2. Калиевый (K⁺) электрод – до 10 шт.

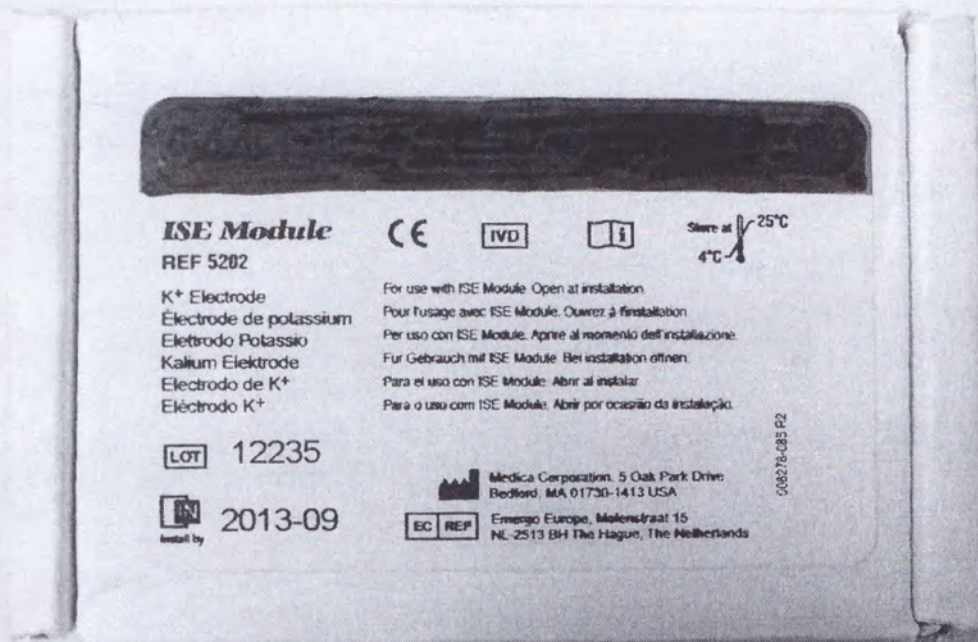

ISE Module

REF 5204

Reference Electrode
Électrode De Référence
Elettrodo Di Riferimento
Bezugs Elektrode
Electrodo de referencia
Electrodo de referência

For use with ISE Module
 Pour l'usage avec ISE Module
 Per uso con ISE Module
 Für Gebrauch mit ISE Module
 Para el uso ISE Module
 Para o uso com ISE Module



Store at 25°C

LOT 12250

2013-09

五

Medical Corporation, 5 Oak Park Drive



Copyright Clearance Center, Inc. 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. 978-750-8400. Fax 978-750-4744. www.copyright.com

008279-034 P2

6. Реагентный пакет $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-/\text{Li}^+$ - до 10 шт.

ISE Module
Na⁺ K⁺ Cl⁻ Li⁺

 $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{Cl}^- \text{Li}^+$

Reagent Pack
Pack de Réactifs
Confezione di Reagenti

Regenzpack

Embriões de Reagente

REF 5420 -0130



For *in vitro* diagnostic use with the 15E
Module. Contains: Calibrator A, 520 nM
[14-8], 142.0 nmol/L; K⁺, 4.00 mmol/L;
Ca²⁺, 125.0 nmol/L; L⁺, 1.0 mmol/L;
Calibrator B, 192 nM [14-8], 70.0 nmol/L;
K⁺, 6.0 mmol/L; Ca²⁺, 41.6 nmol/L; L⁺,
0.4 mmol/L; buffer + preservation;
working signal.

Pour les diagnostics *in vitro*, utiliser ce module avec le SE Module. Coefficient Solution d'étalonnage A, 520 ml (Na⁺, 140,0 mmol/L; K⁺, 4,00 mmol/L; Cl⁻, 125,0 mmol/L; Li⁺, 1,0 mmol/L; solution d'étalonnage B, 160 ml (Na⁺, 130,0 mmol/L; K⁺, 8,0 mmol/L; Cl⁻, 41,0 mmol/L; Li⁺, 0,4 mmol/L; tampon; agent de conservation; agent résultant).

Per uso diagnostico *in vitro* con le ISE.
Mediale. Contiene: Cellule ante A, 520 ml
[14.5], 340.0 mmol/L • K⁺, 4.00 mmol/L •
Cl⁻, 125.0 mmol/L • L⁻, 1.0 mmol/L •
Cellulente B, 190 ml [14.5], 70.0 mmol/L •
K⁺, 8.0 mmol/L • Cl⁻, 41.5 mmol/L • L⁻, 0.4
mmol/L • Tampone preservante •
Spente immortale



STOCKING YOUR HOME WITH ESSENTIALS
FOR EMERGENCIES / BY JENNIFER K. HARRIS

10131209





2014-08

Medical Corporation, 55 East Park Drive


Energy Forged, Minnesota 1.5
86-2613 For The Nation The New

005529-001 R1


9. Сервисный набор для ион-селективного (ISE) модуля: Ватная палочка; Шприц 10 мл; Желтая игла; Розовая игла; Синяя игла; Основной очиститель; Синяя трубка; Прямоугольная бутылка.

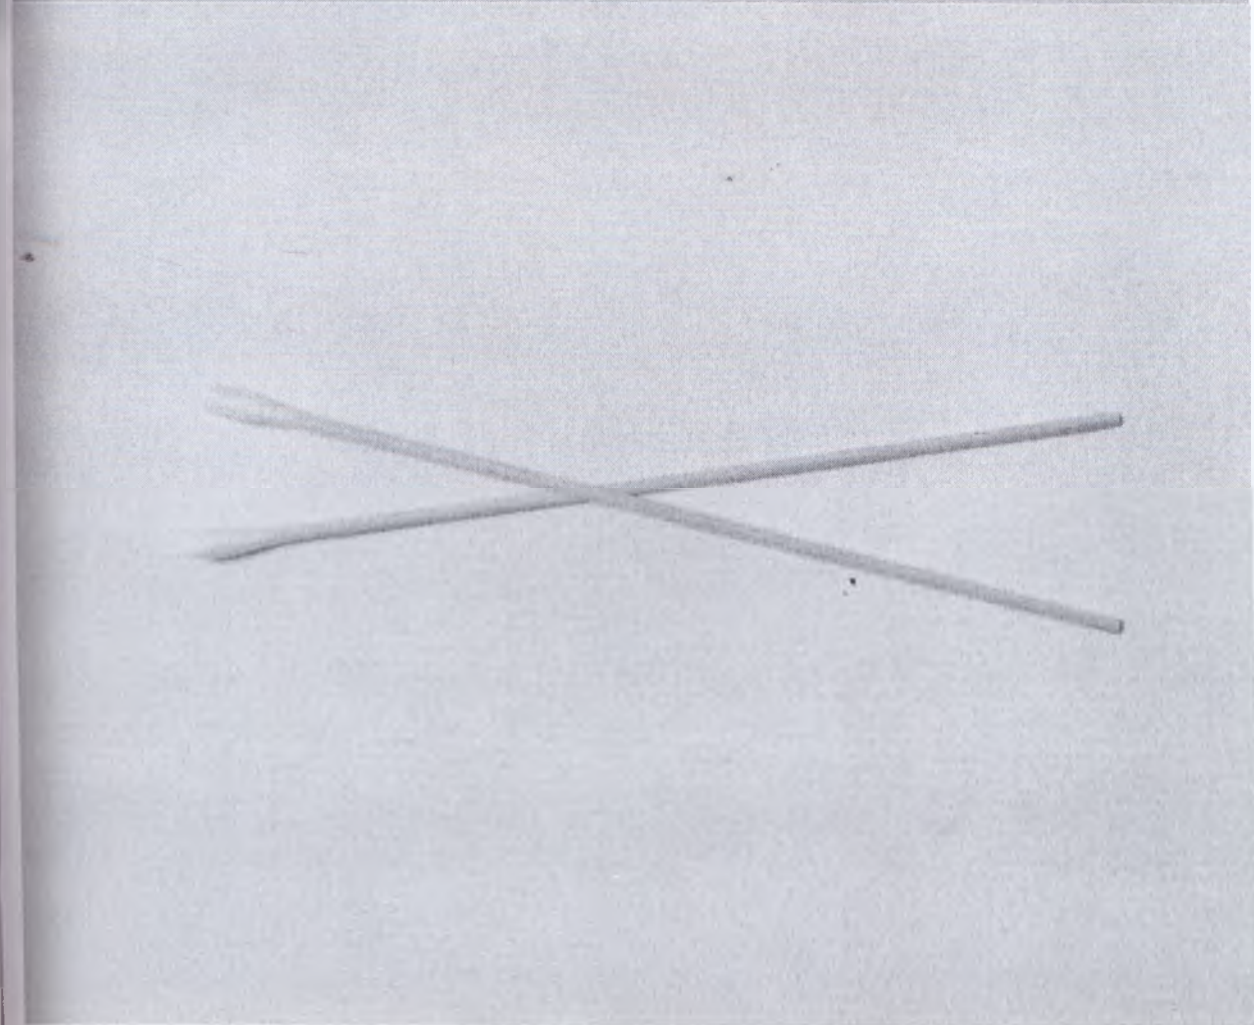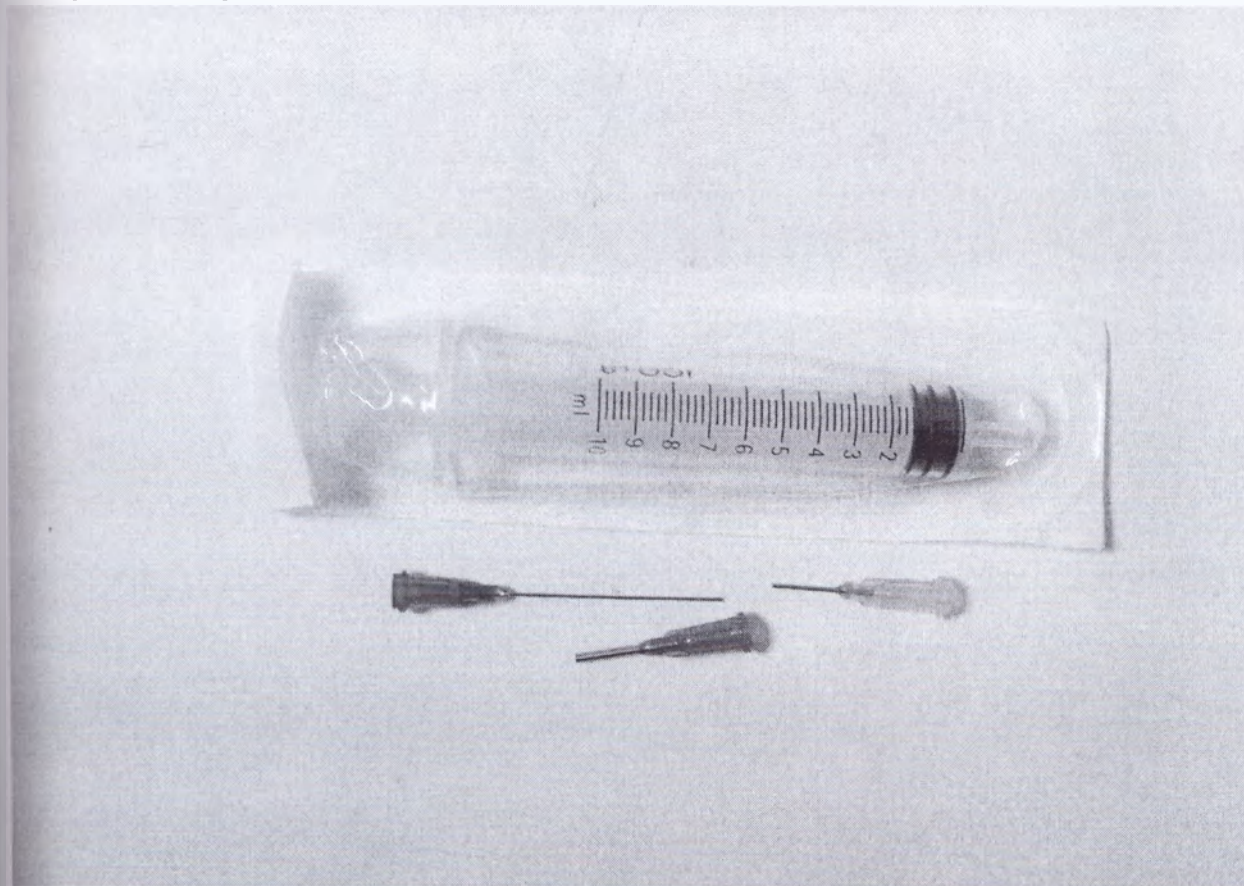


2 14. Реагентный пакет $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-/\text{Li}^+$ (без емкости для отходов) – до 10 шт.

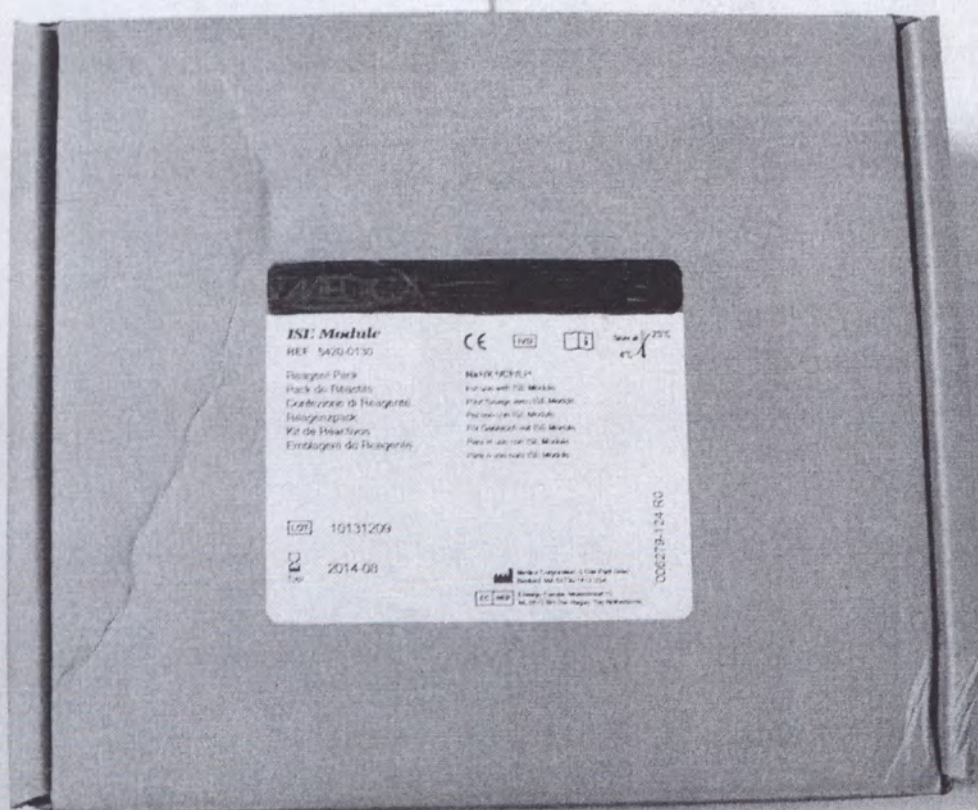


15. Серийный кабель COM (RS232) – до 5 шт.

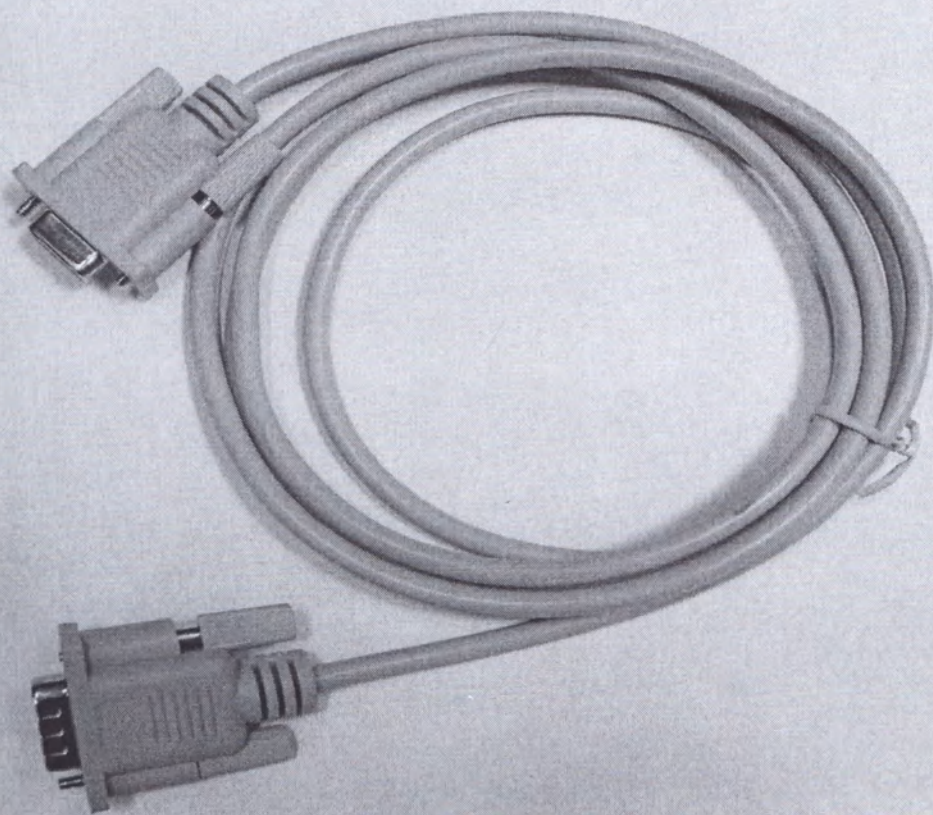


16. Крепеж реакционного ротора – до 5 шт.

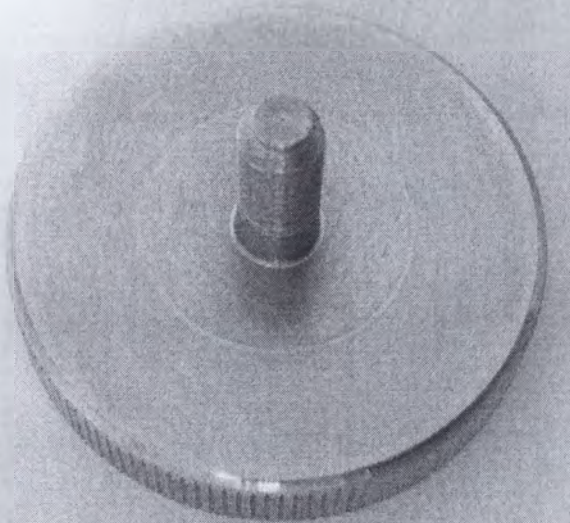


17. Реагентный флакон темный 60 мл – до 10 шт.

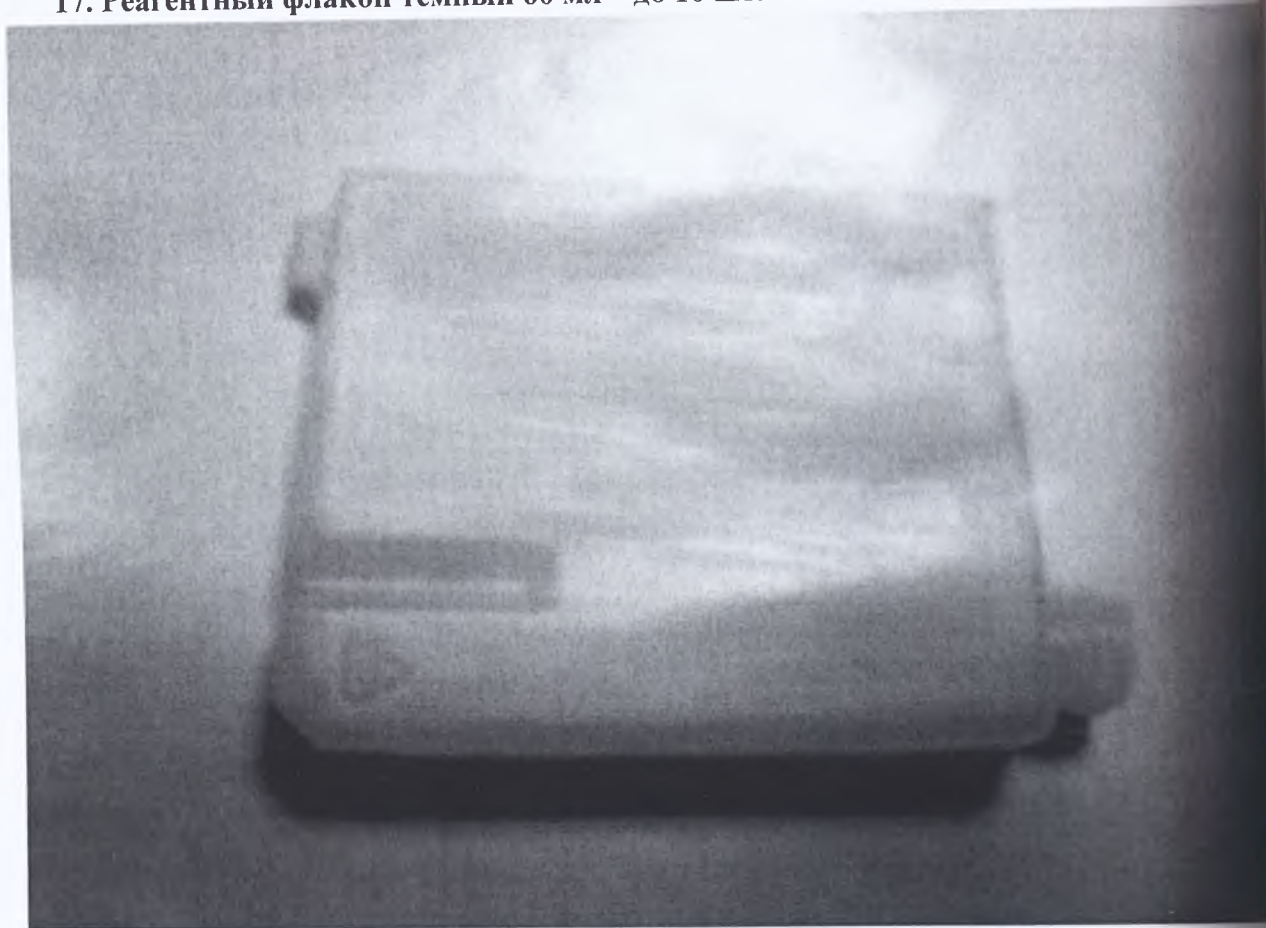


18. Реагентный флакон темный 20 мл – до 10 шт.

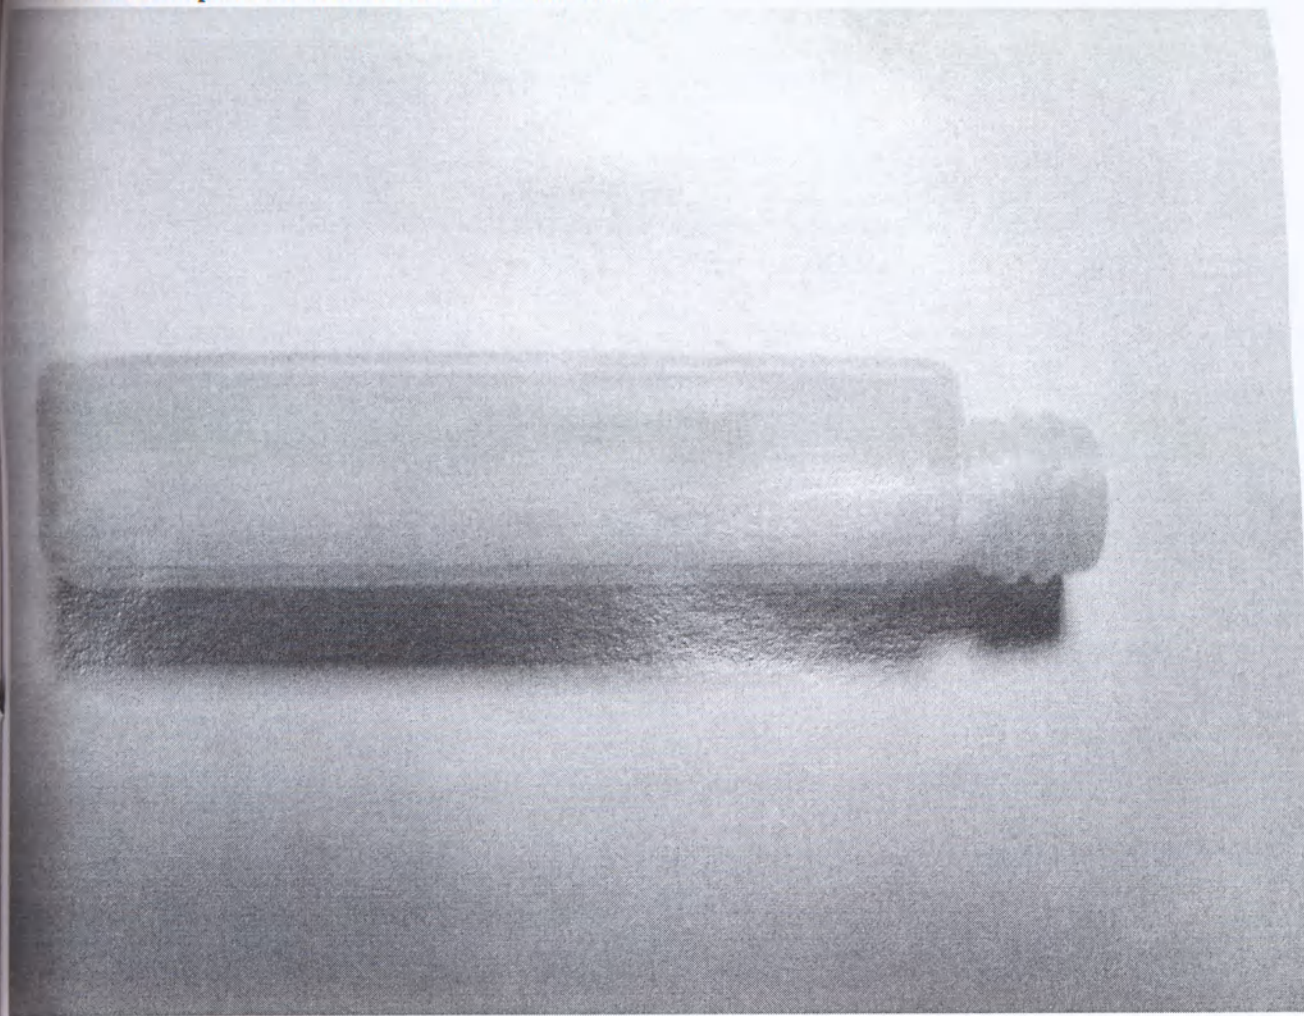


19. Концентрированный моющий раствор 100 мл – до 10 шт.

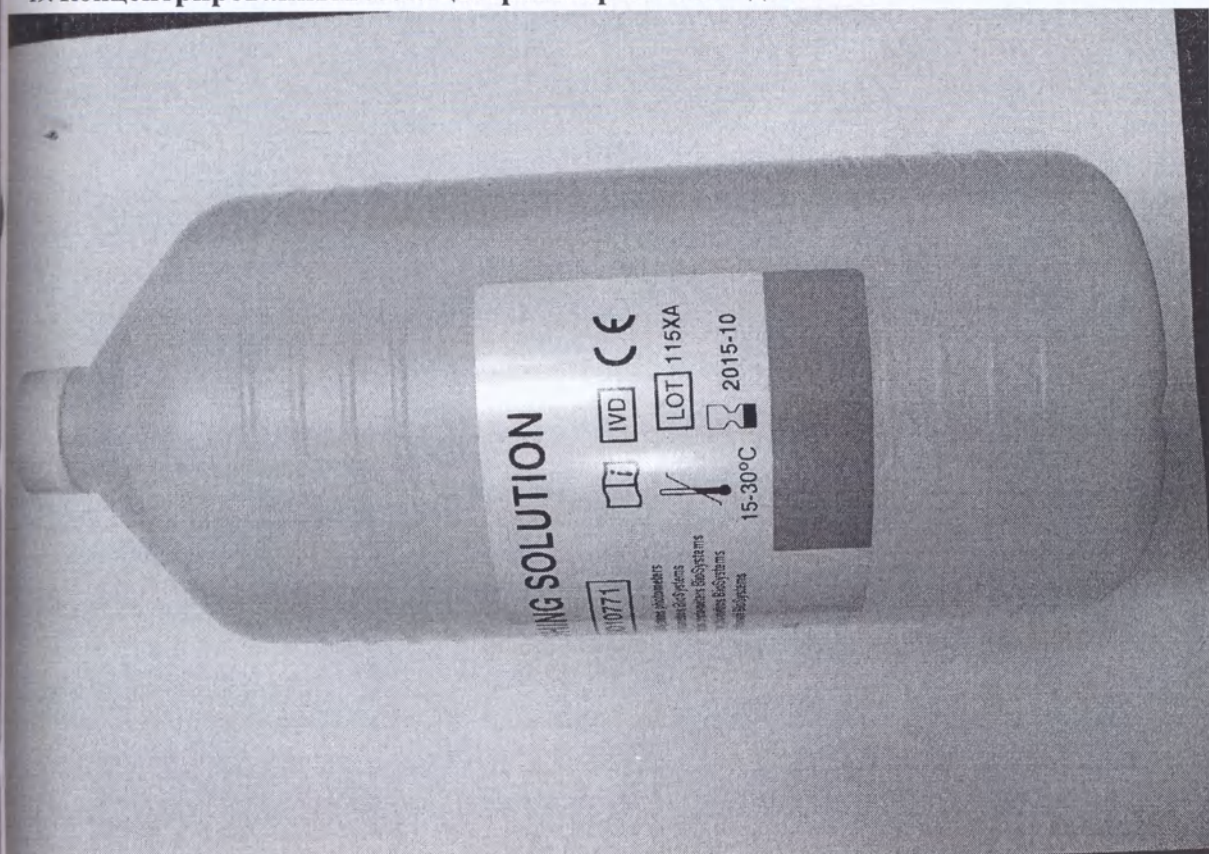


20. Емкость для моющего раствора без крышки – до 10 шт.

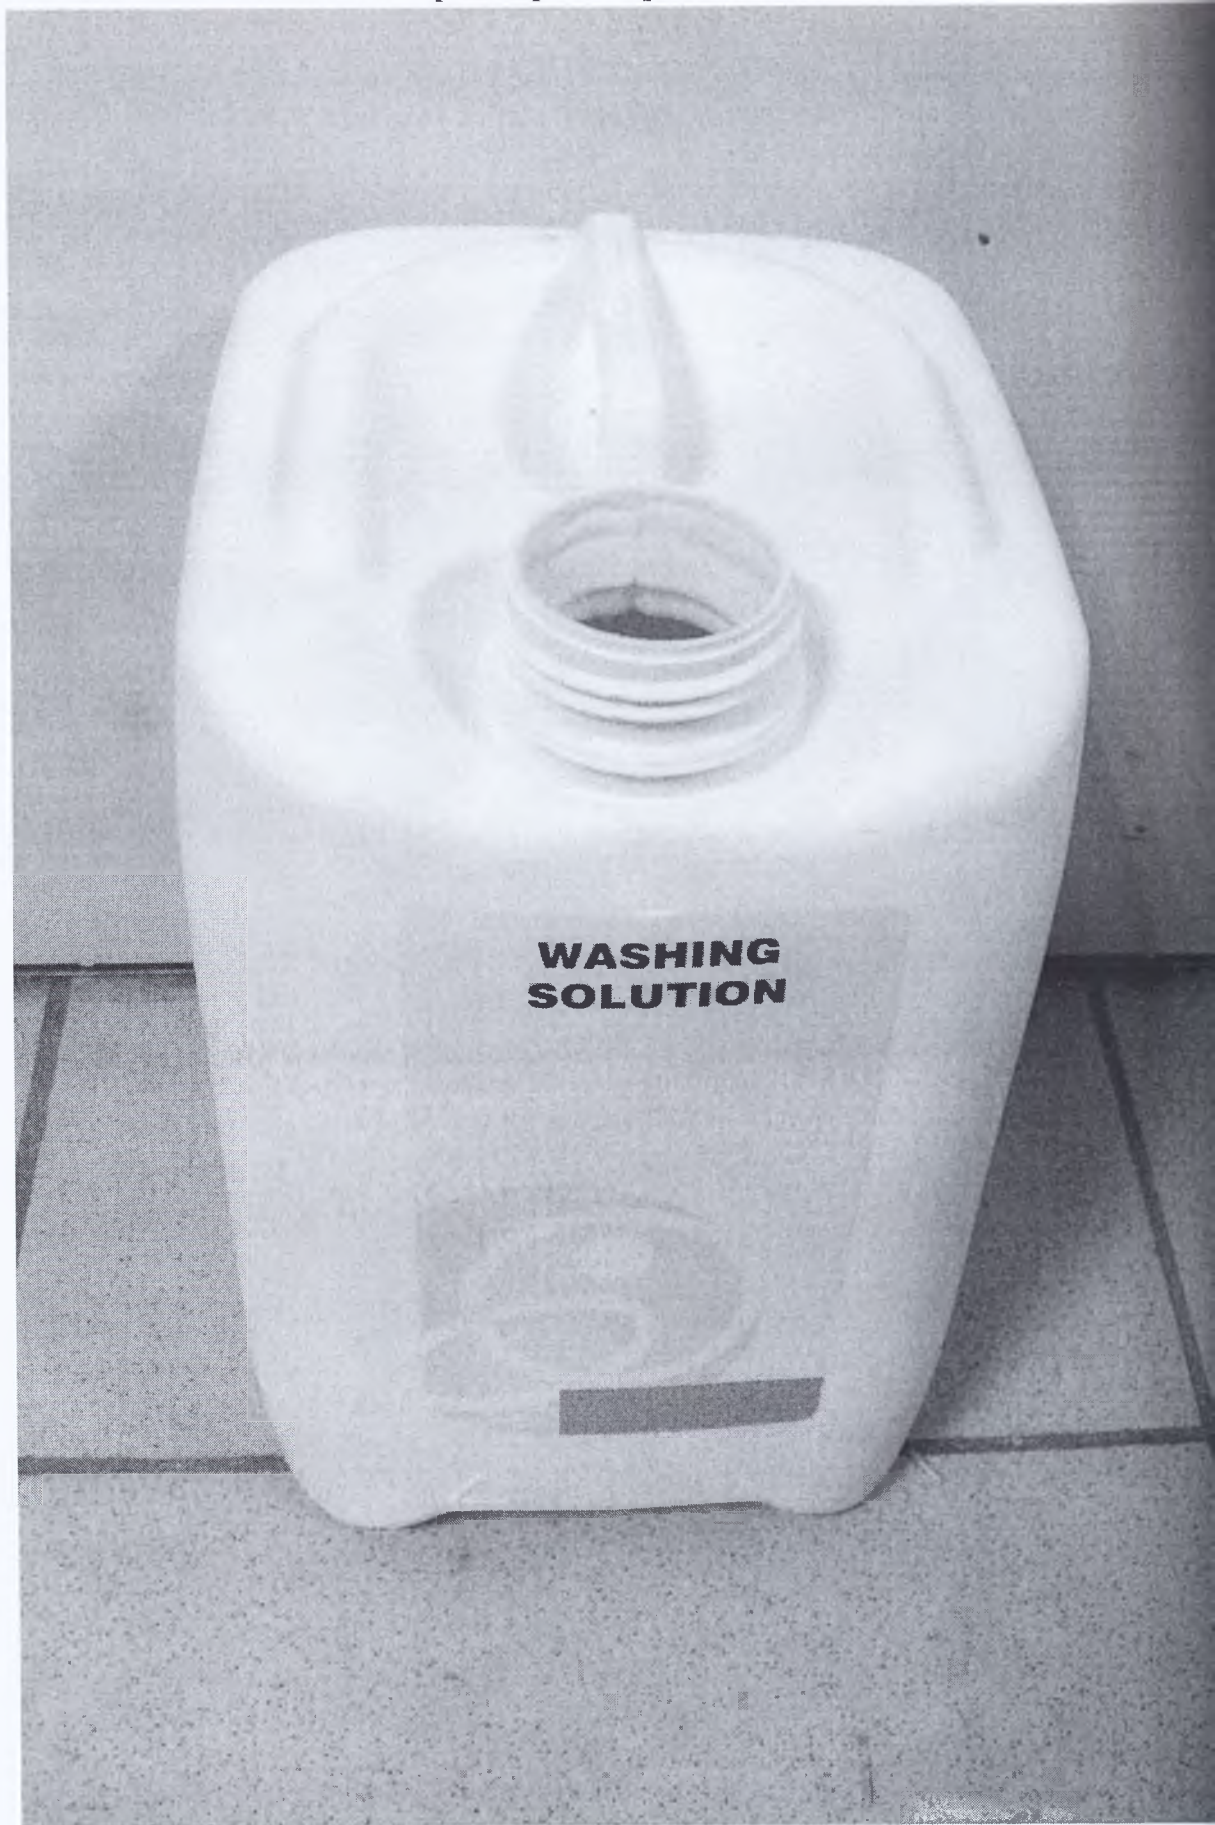


21. Емкость для опасных отходов без крышки – до 10 шт.

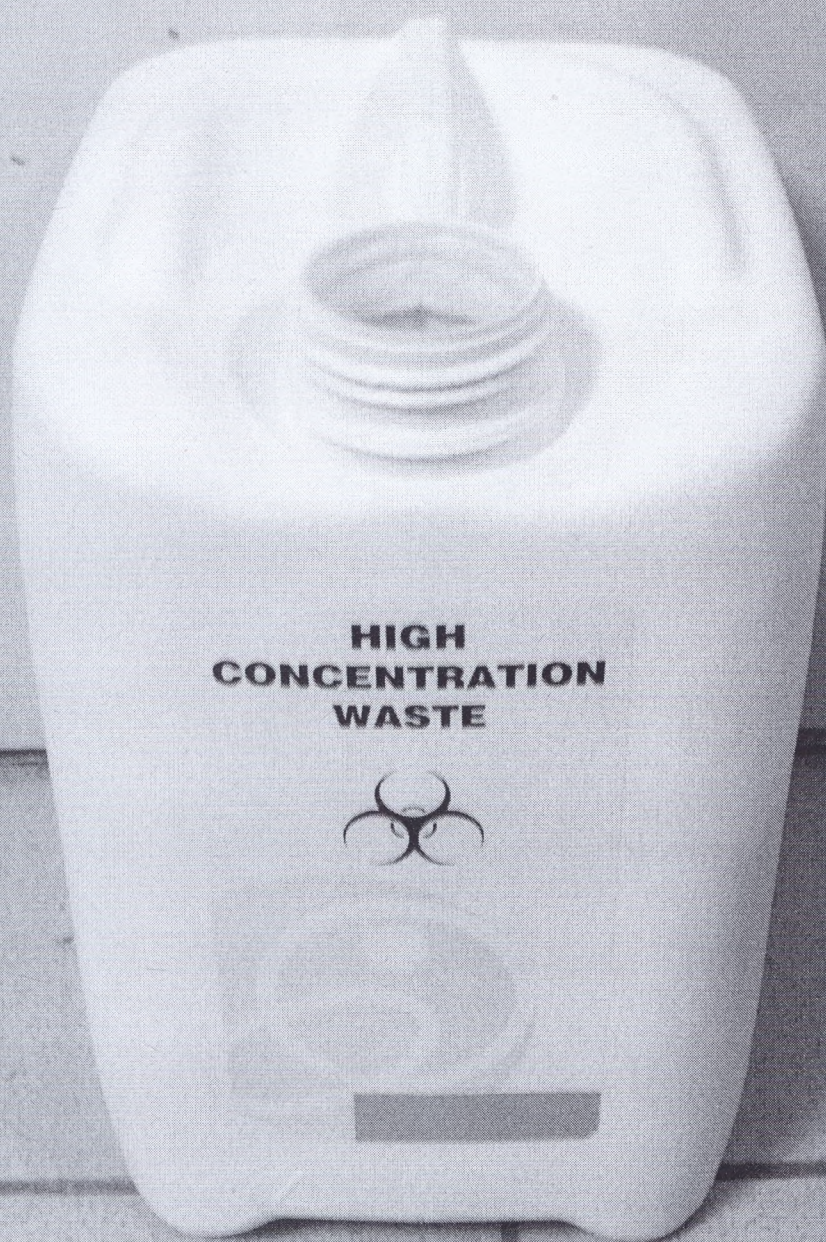

22. Крышка емкости для моющего раствора – до 10 шт.

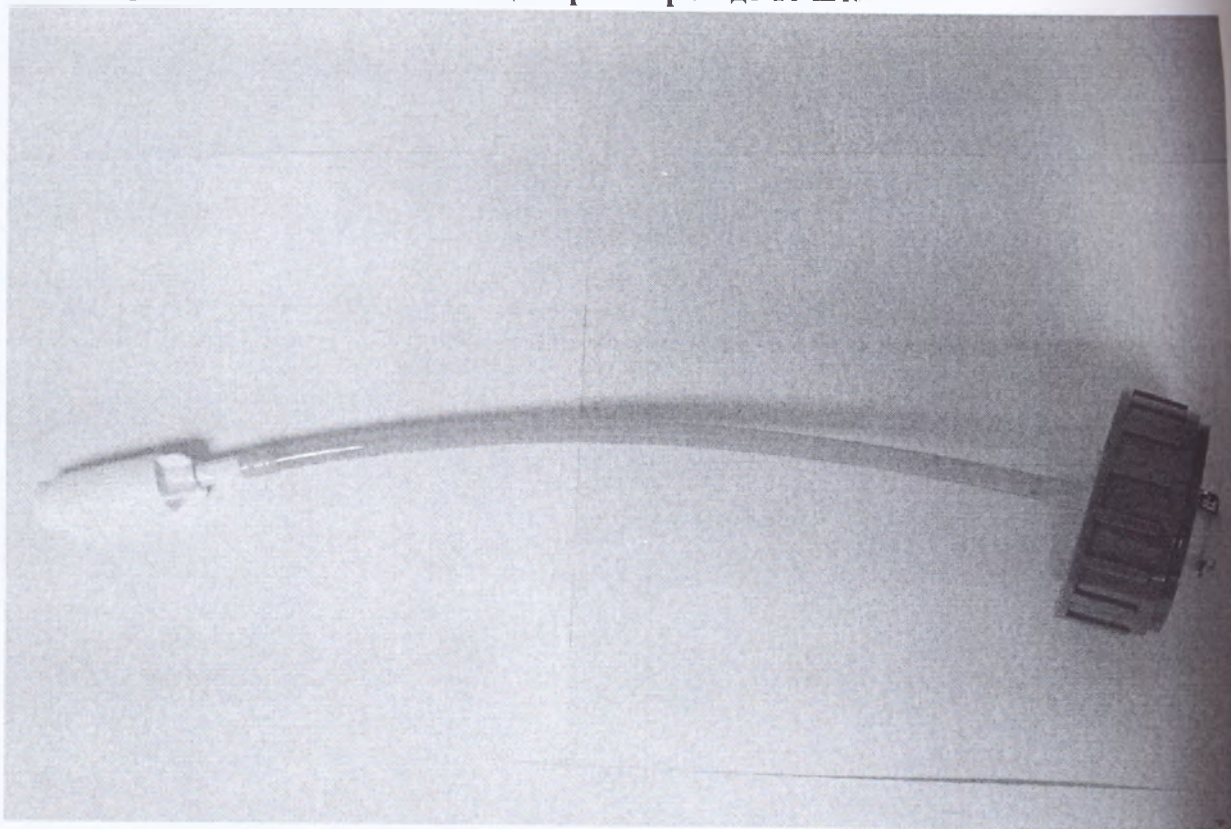


23. Крышка емкости для опасных отходов – до 10 шт.

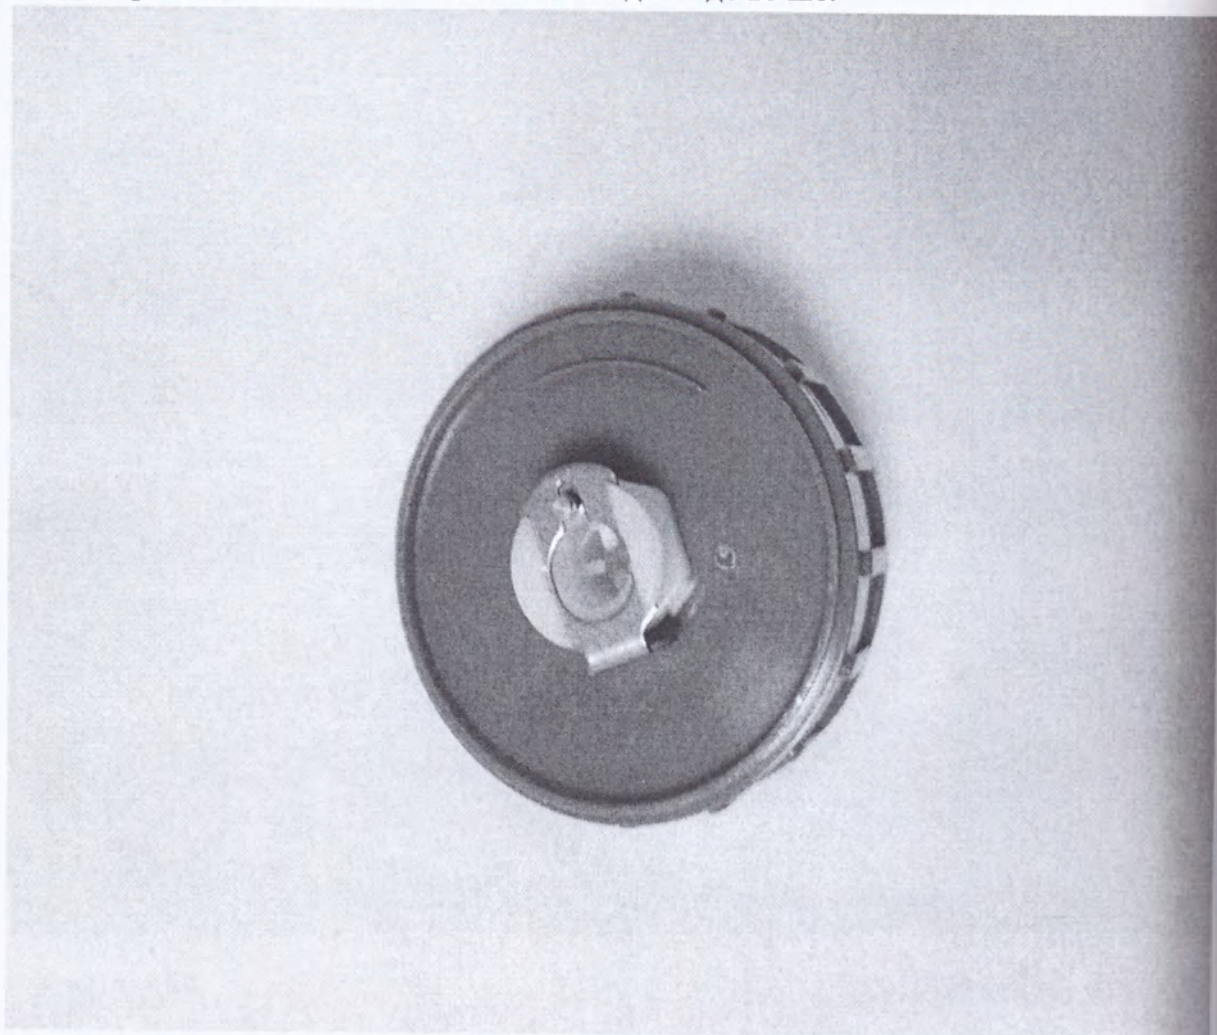

24. Коробка для аксессуаров ВА400 – до 5 шт.




25. Коробка для аксессуаров ISE блока BA400 – до 5 шт.

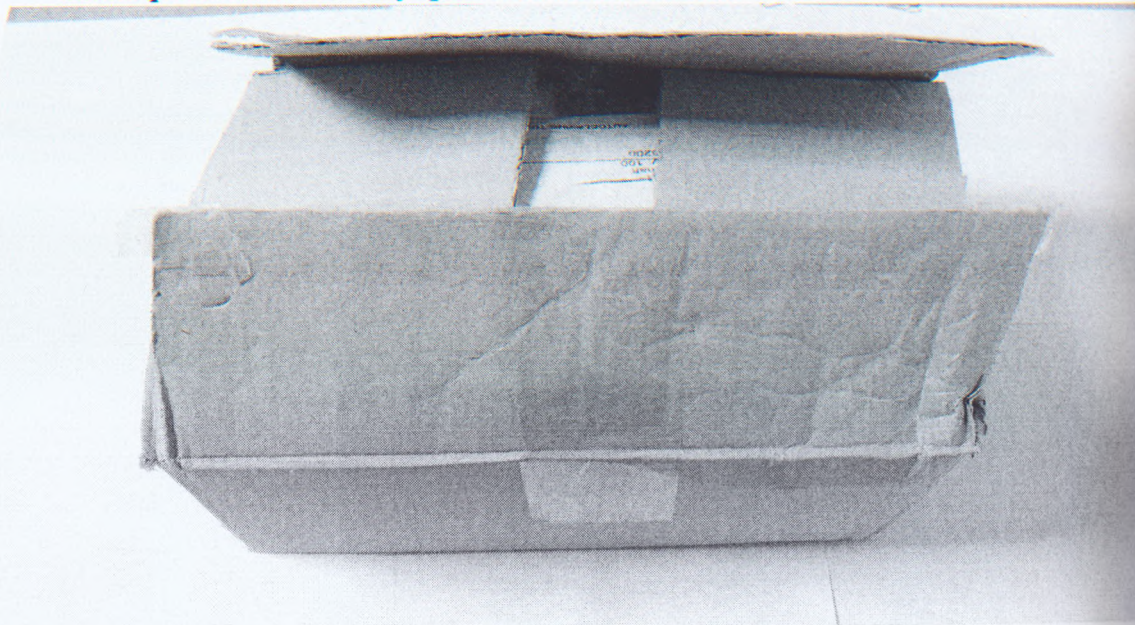


- 26. Светофильтр 340 нм – до 10 шт.
- 27. Светофильтр 405 нм – до 10 шт.
- 28. Светофильтр 505 нм – до 10 шт.
- 29. Светофильтр 535 нм – до 10 шт.
- 30. Светофильтр 560 нм – до 10 шт.
- 31. Светофильтр 600 нм – до 10 шт.
- 32. Светофильтр 635 нм – до 10 шт.
- 33. Светофильтр 670 нм – до 10 шт.




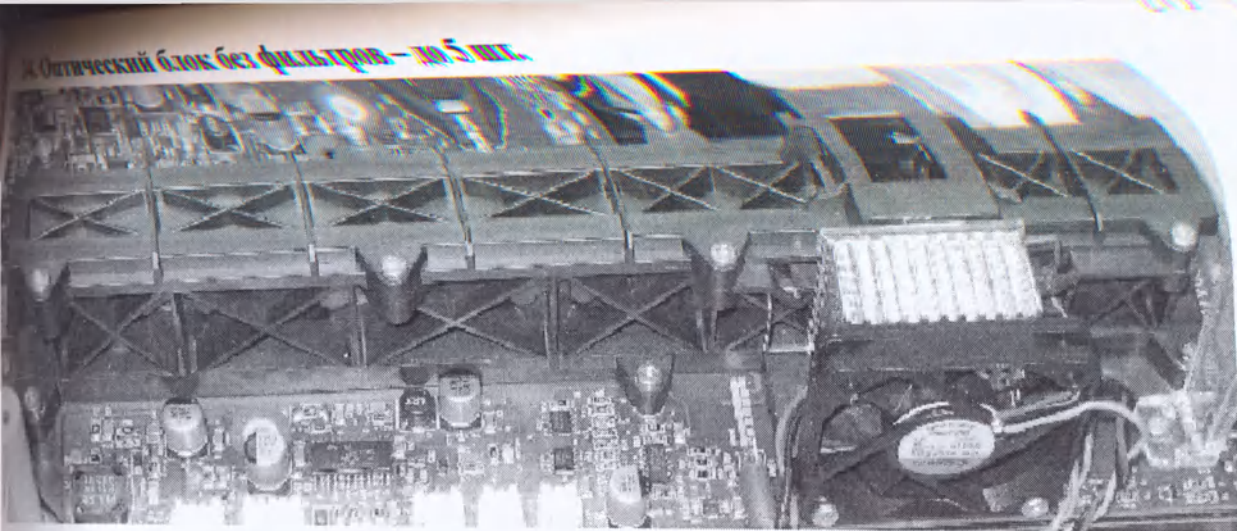


35. Набор трубок для 4-канального калибратора А/В/отходы: 2 трубки калибратора; 1 трубка для отходов – до 10 шт.

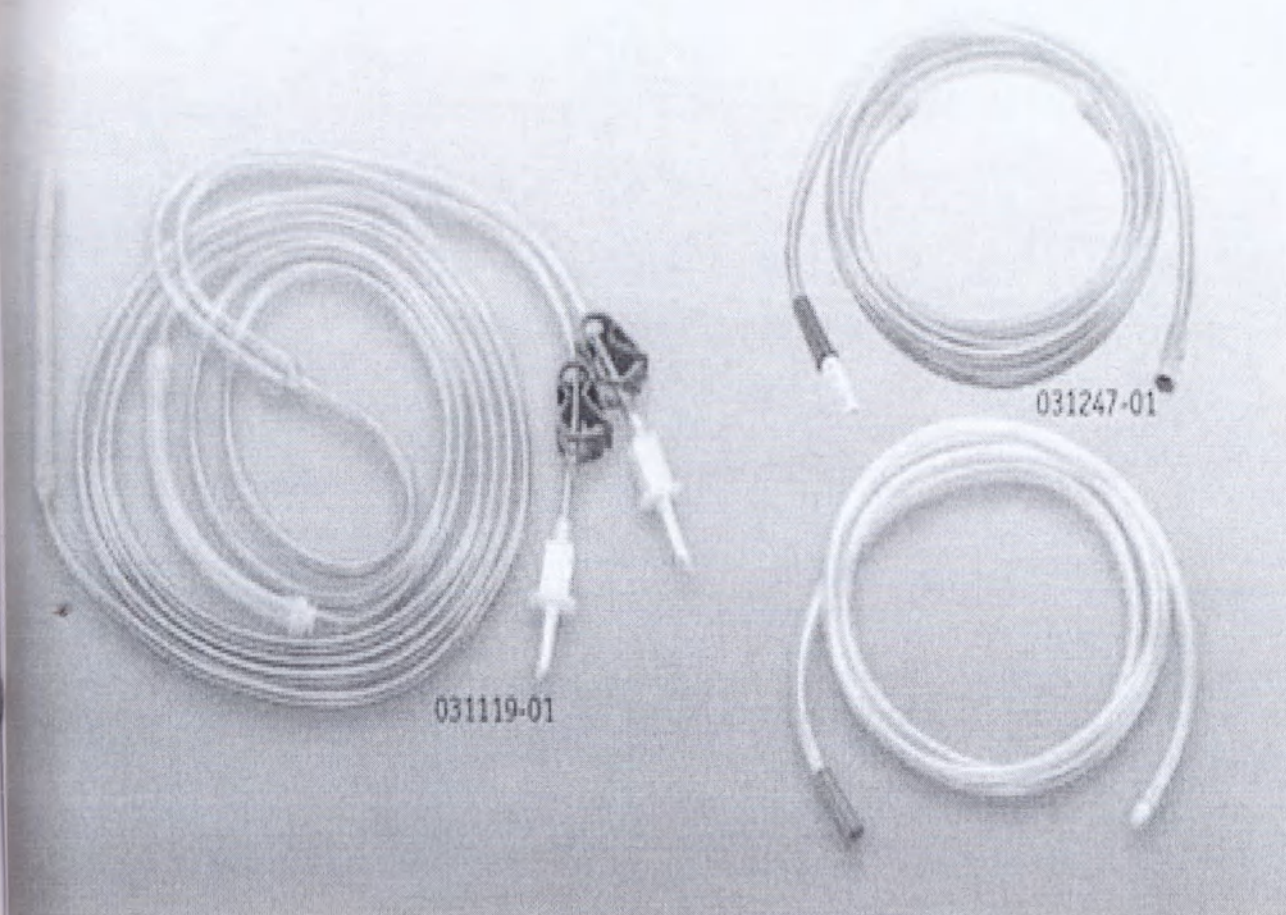

36. 4-канальный набор колец для замены: 1 кольцо пробирок для проб; 1 кольцо детектора воздушных пузырей; 1 кольцо прижимной пластины.

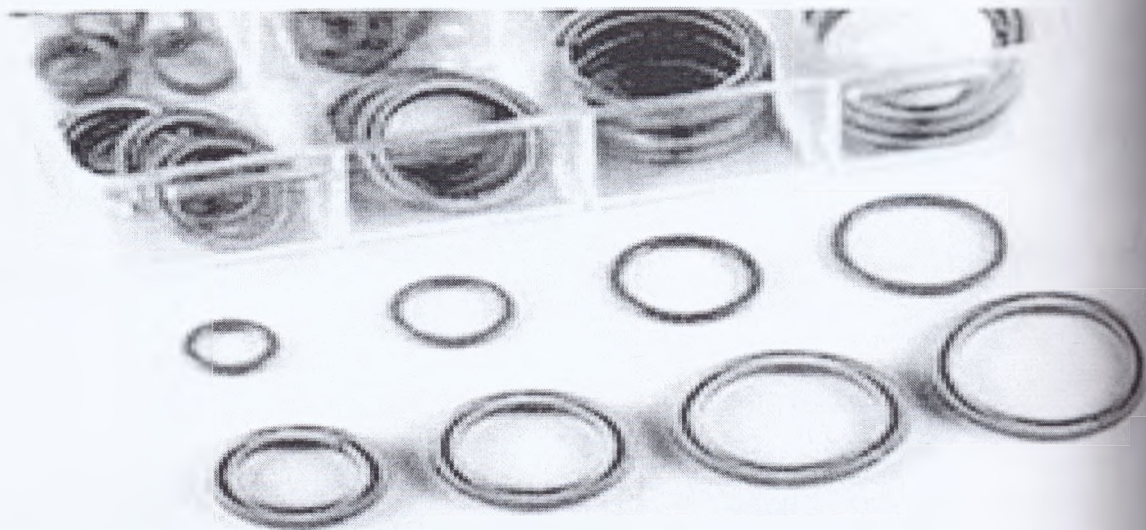

37. 4-канальный набор колец электродов: 4 кольца.

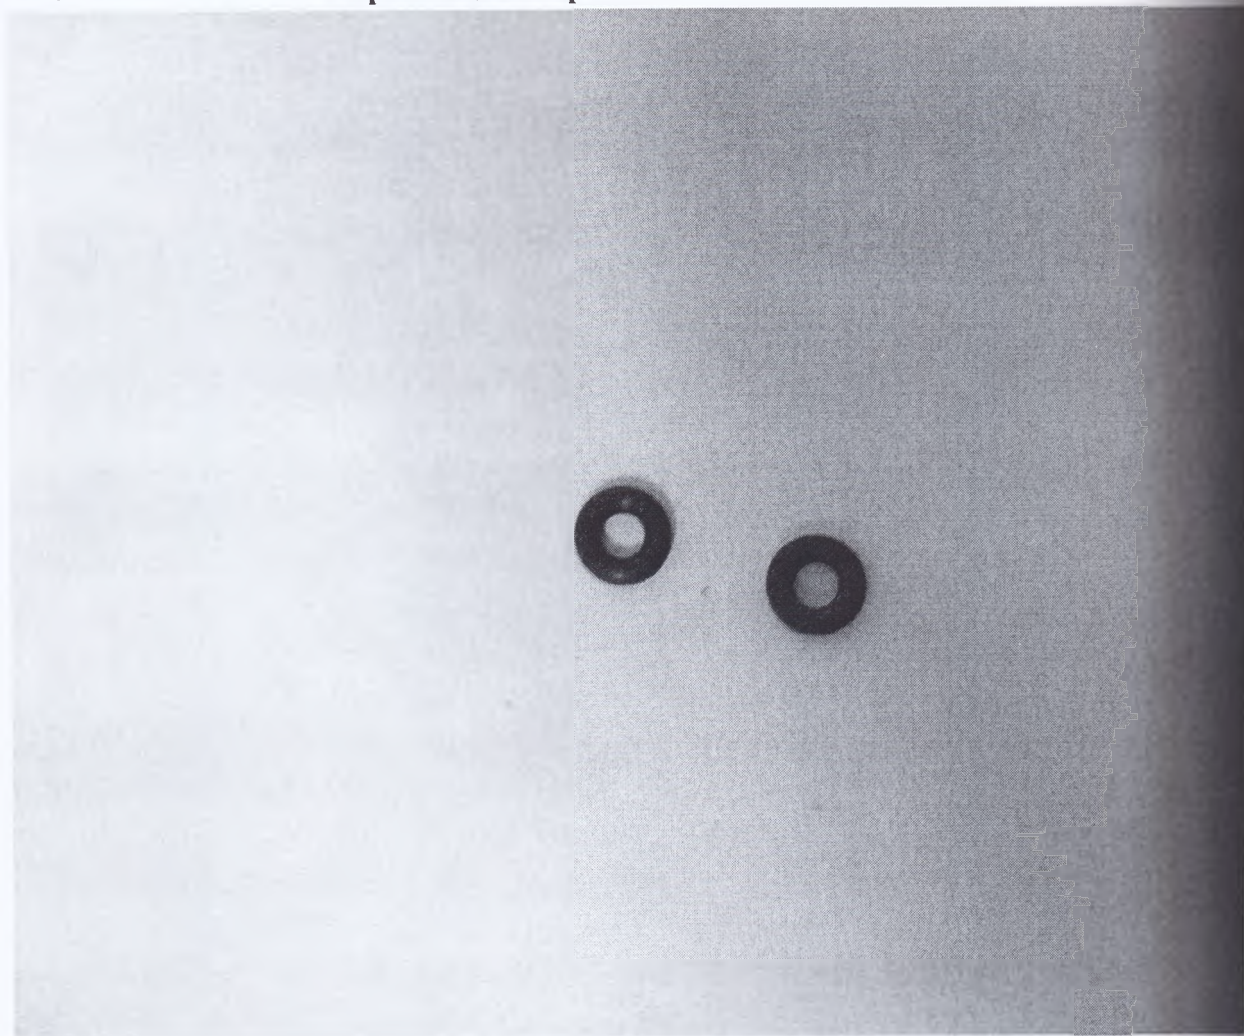


38. 4-канальный адаптер, прямоугольный – до 10 шт.




39. 4-канальный набор для пробирок: 1 пробирка для проб; 1 винт; 1 кольцо – до 10 шт.




61

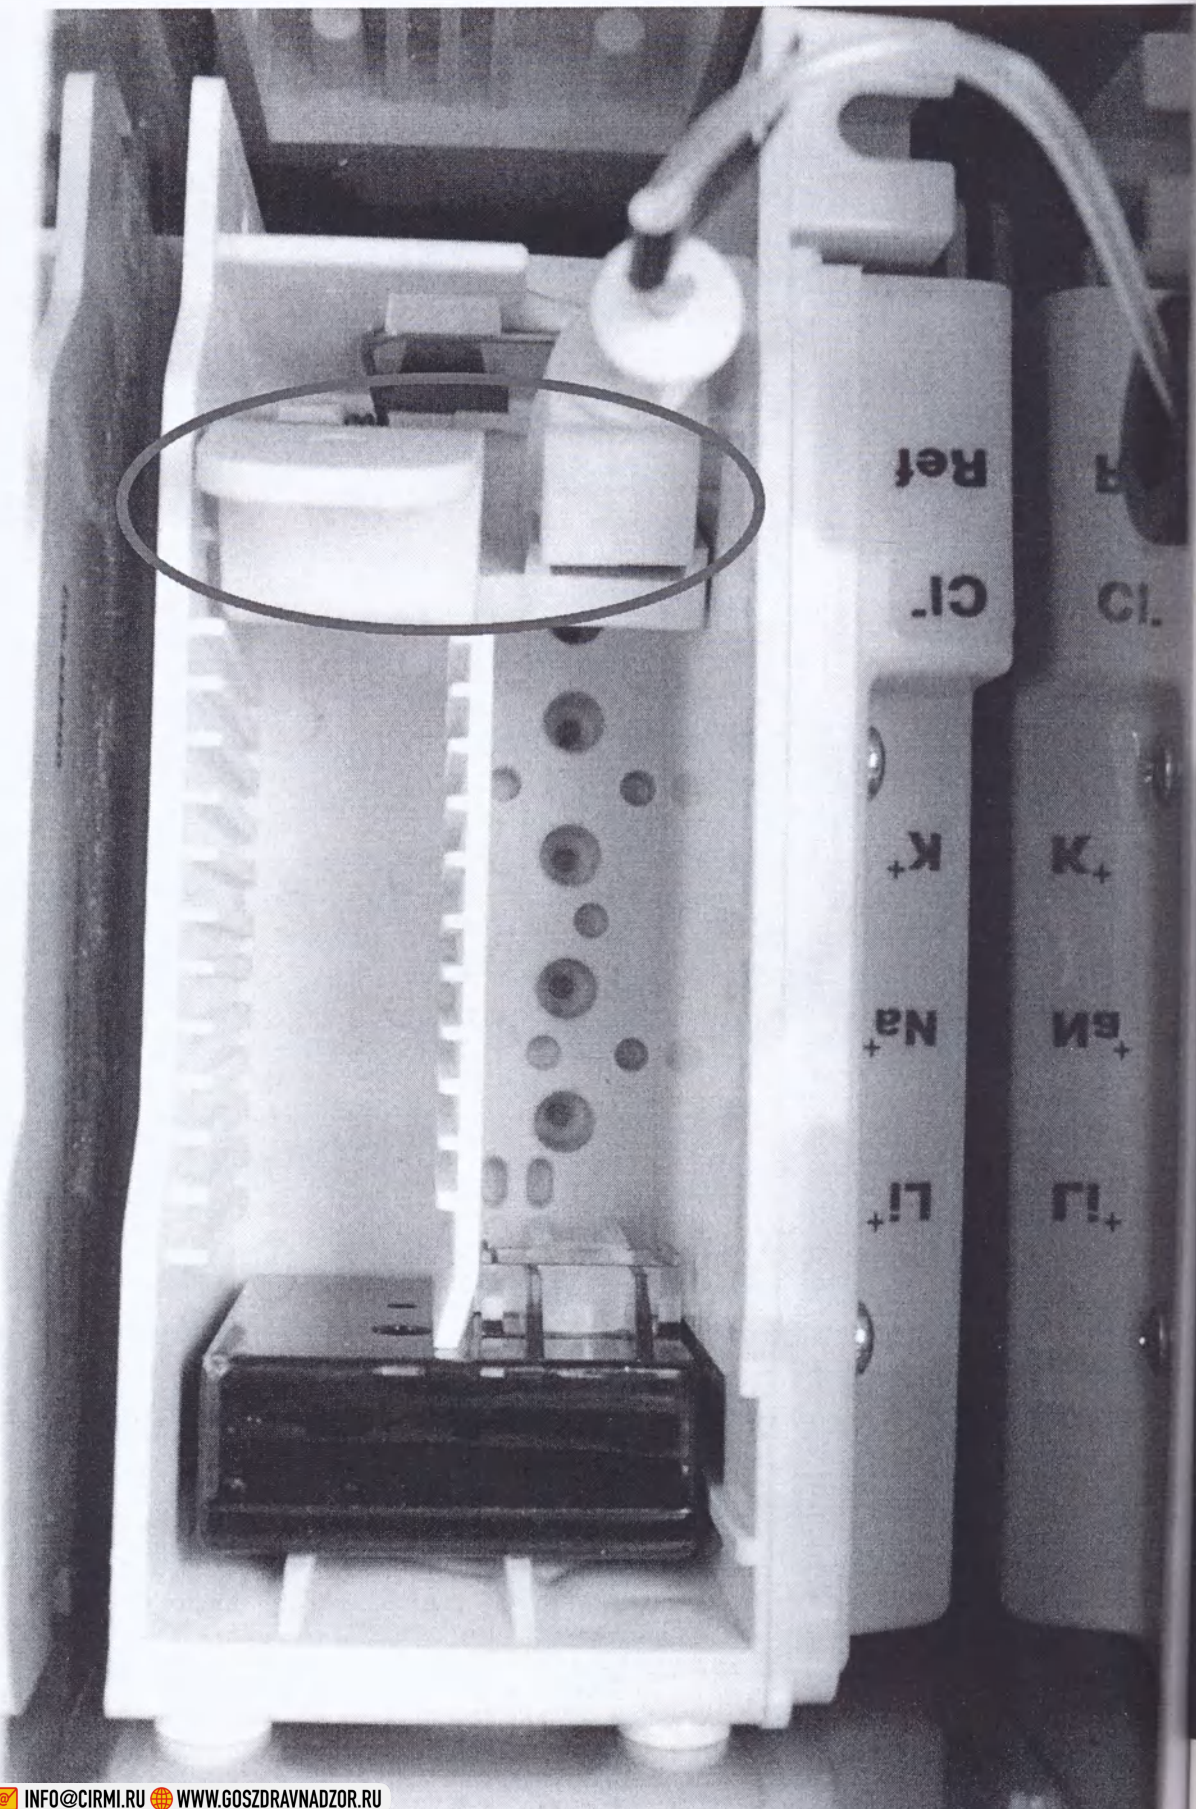


612

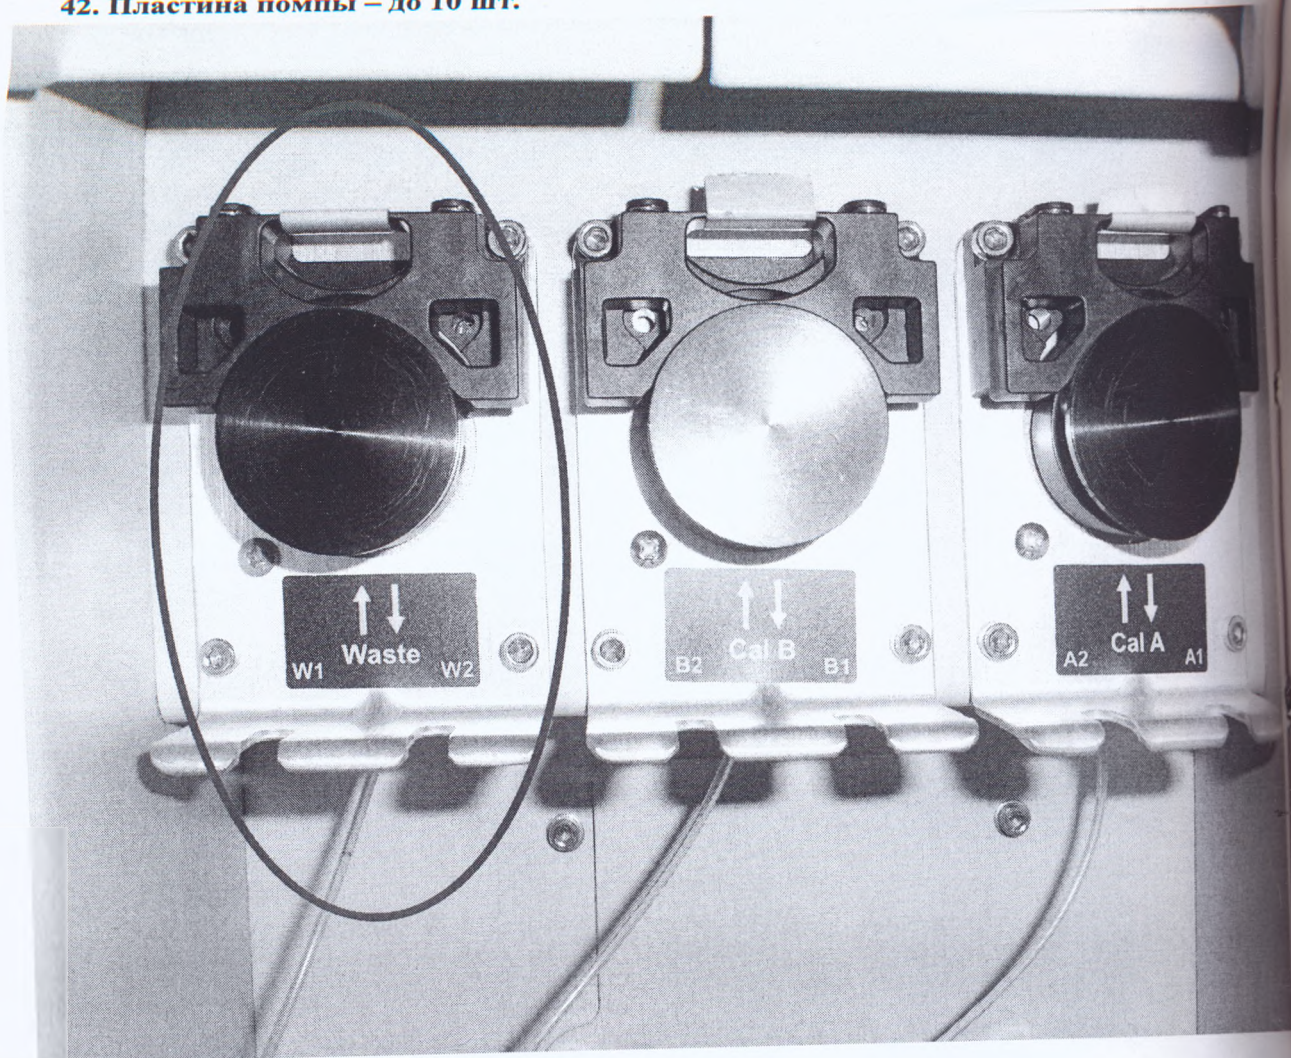


22

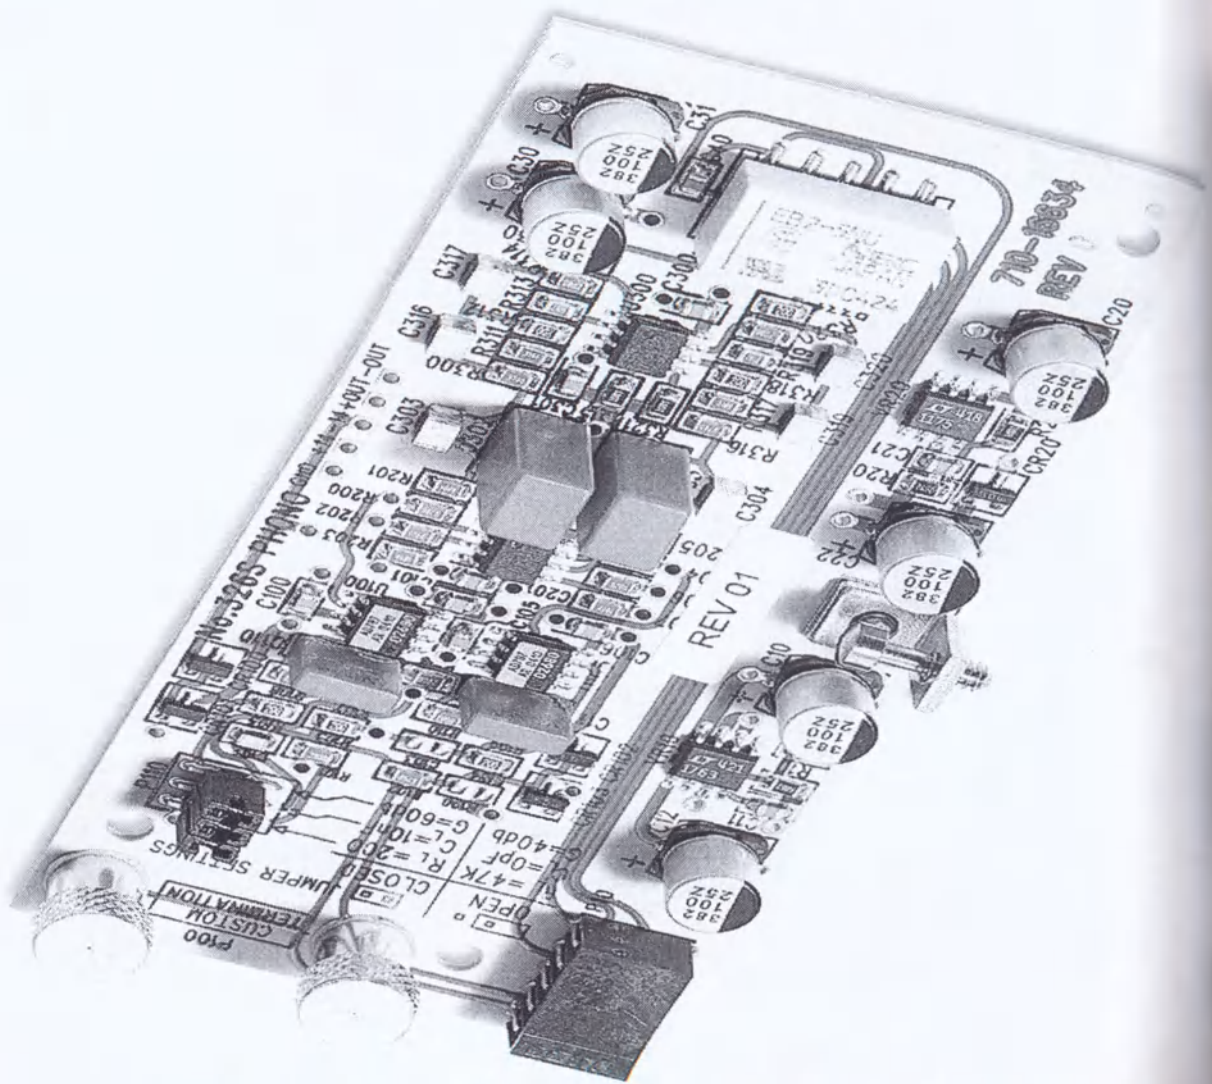

45. Переходник для реагентов ISE модуля, без пластины.

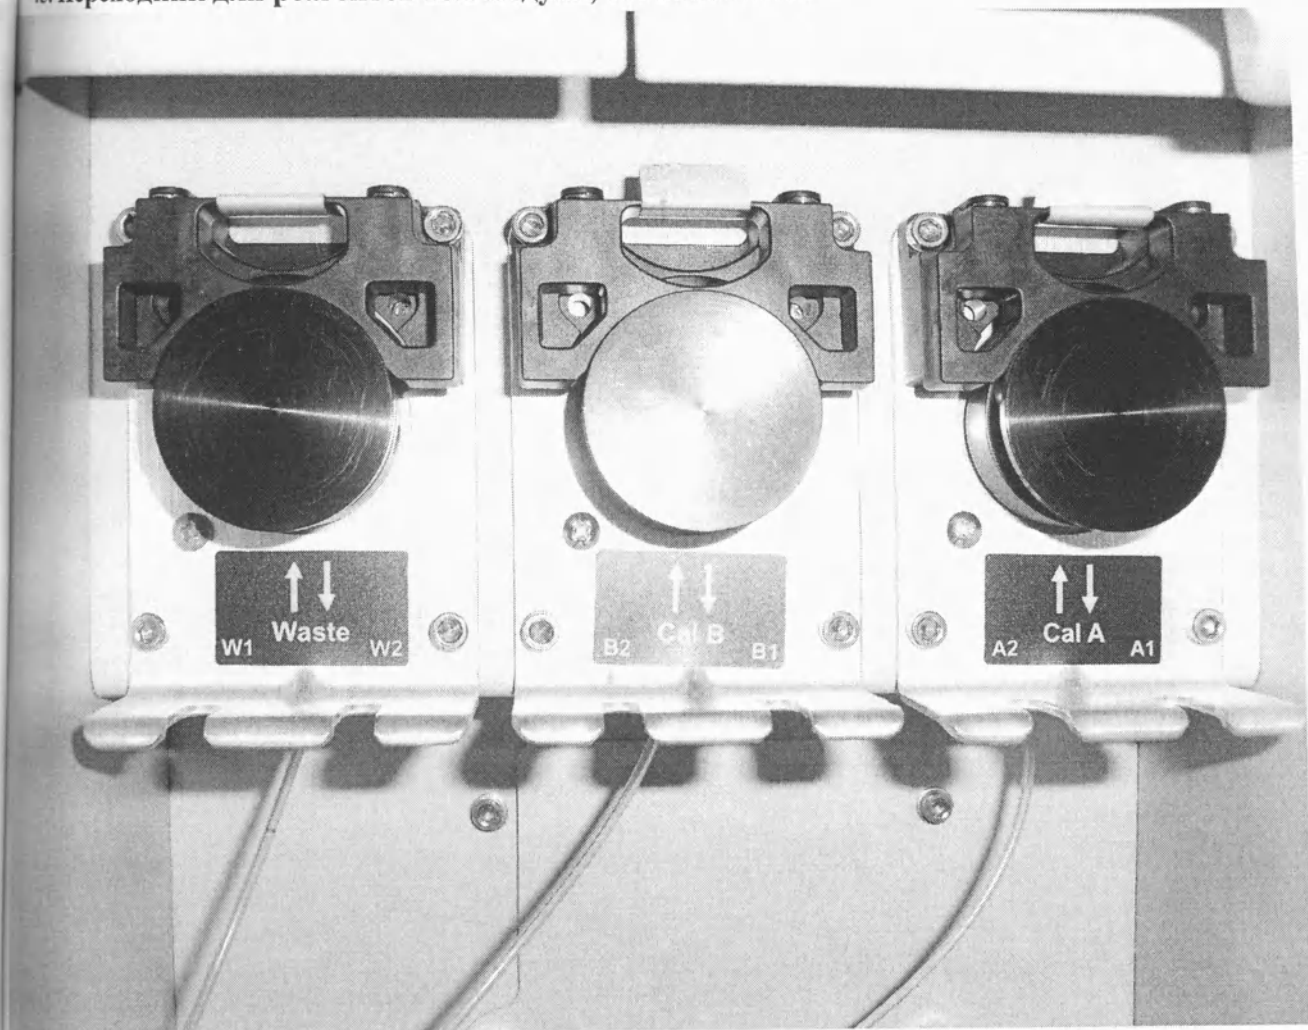


46. 4-канальная помпа – до 10 шт.

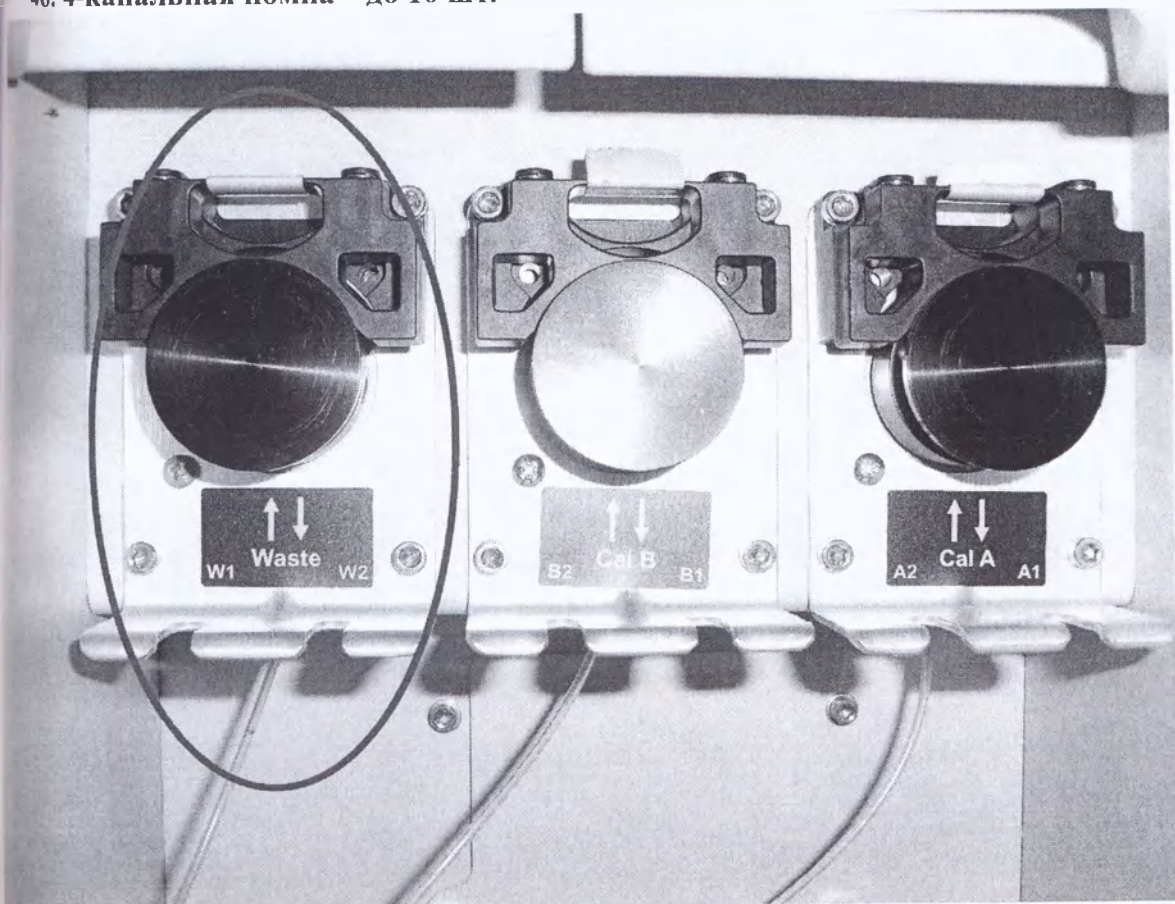


47. Набор трубок к 4 канальной пластине помп: 3 трубки для перистальтического насоса.



48. Сменный набор для 4 канальной пластины помп: 3 перистальтических насоса; 6 шайб – до 10 шт.

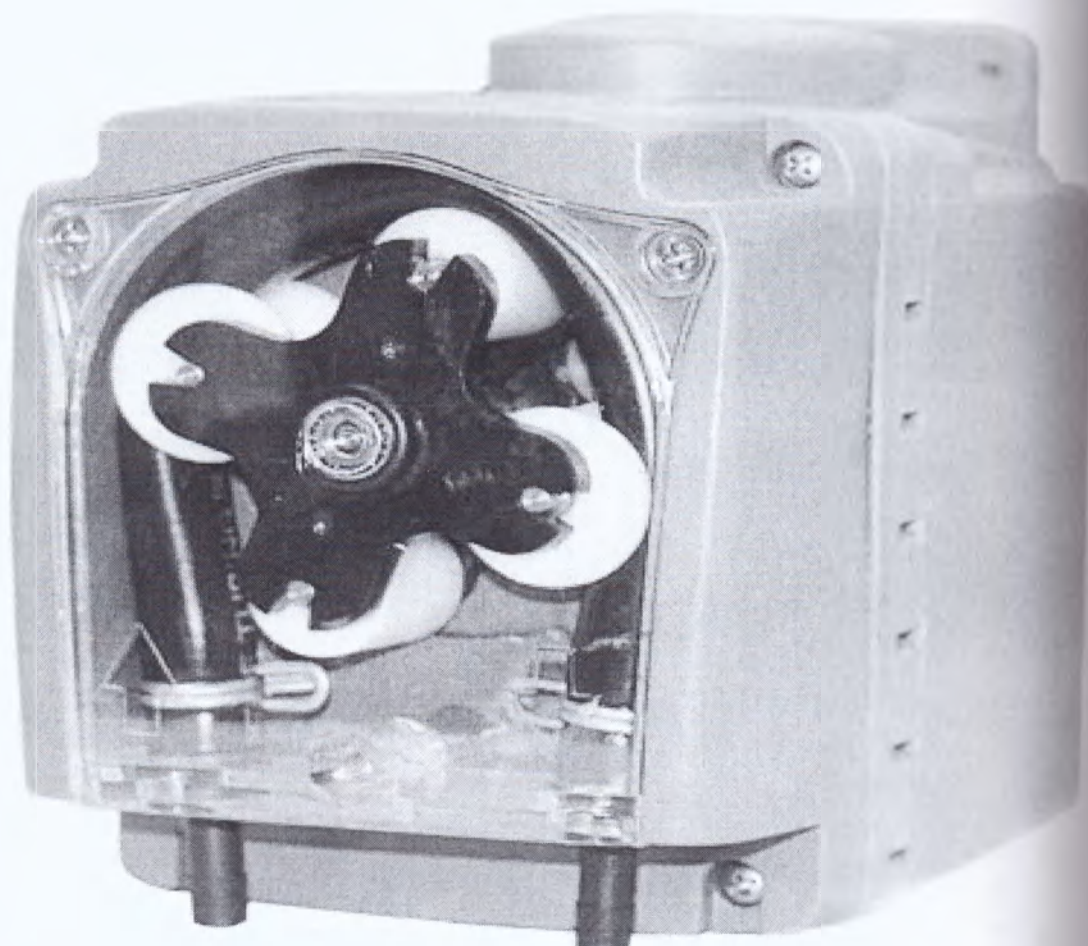

49. Сменный набор одноканального перистальтического насоса: 1 перистальтический насос; 2 винта; 2 шайбы – до 10 шт.

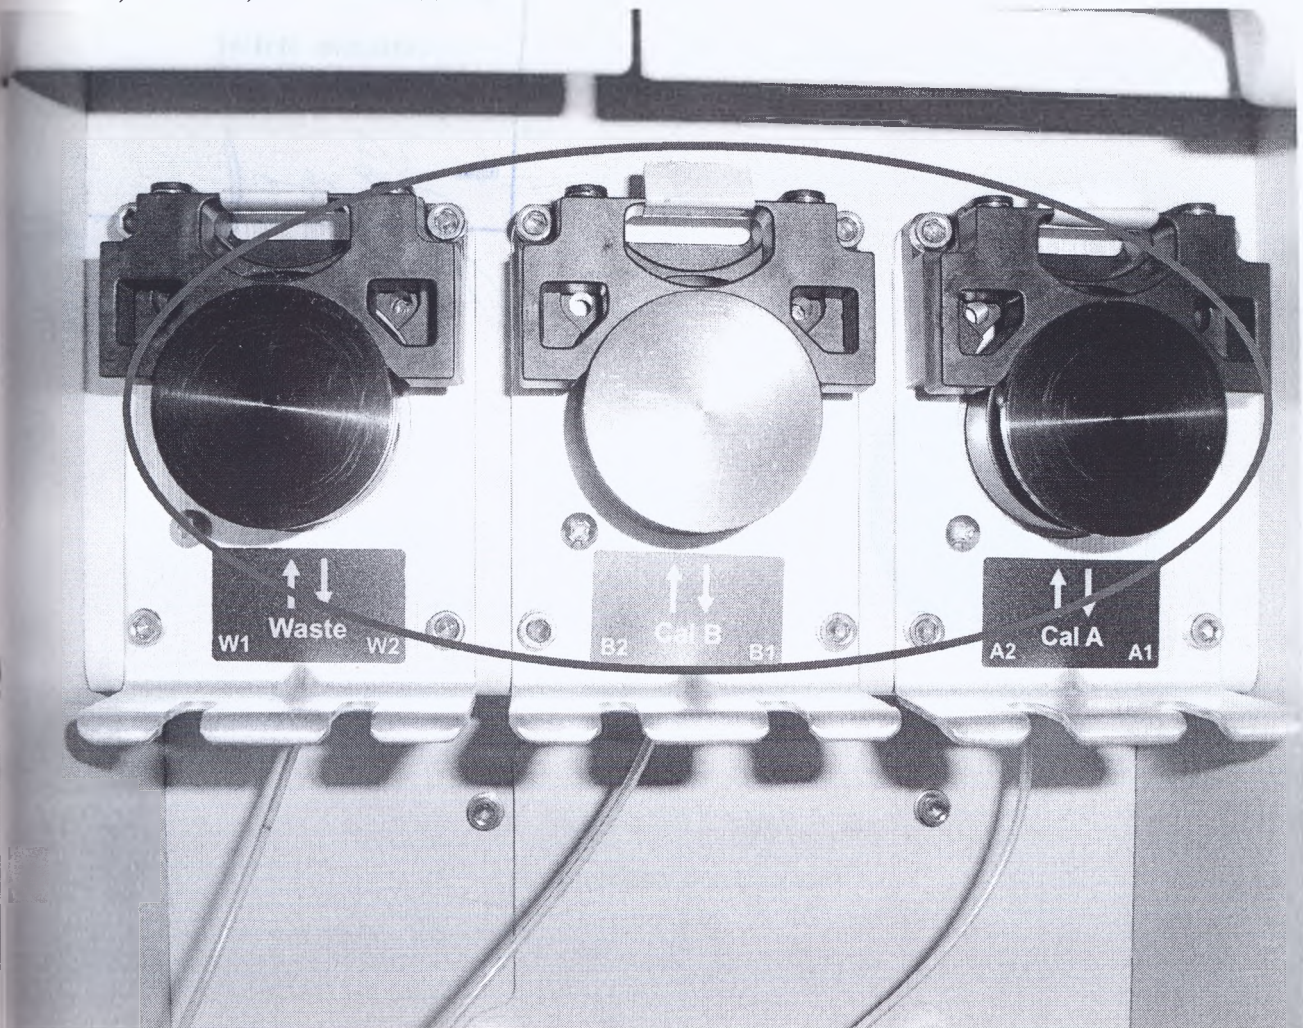

50. Соединитель-коллектор с 4 каналов на 1 трубку – до 10 шт.

