

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Система цифровая маммографическая Amulet In-
novality (FDR MS-3500) с принадлежностями***

Производства

"ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн"

FUJIFILM Corporation

**FUJIFILM Corporation, 26-30 Nishiazabu 2-Chome,
Minato-Ku, Tokyo, 106-8620, Japan, Япония, Даль-
нее зарубежье**

1. Маммографическая установка (FDR-3500DRLH)



**Система цифровая маммографическая
Amulet Innovality (FDR MS-3500)**


Производитель:	ФУДЖИФИЛЬМ	FUJIFILM
	Корпорейшн,	Corporation,
Страна происхождения:	Япония	Japan
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	АО «Р-Фарм, 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1, тел. 8-495-956-79-37 факс: 8-495-956-79-38 e-mail: info@rpharm.ru	

Регистрационное удостоверение


№ _____ от _____ г.


1. Маммографическая установка (FDR-3500DRLH)

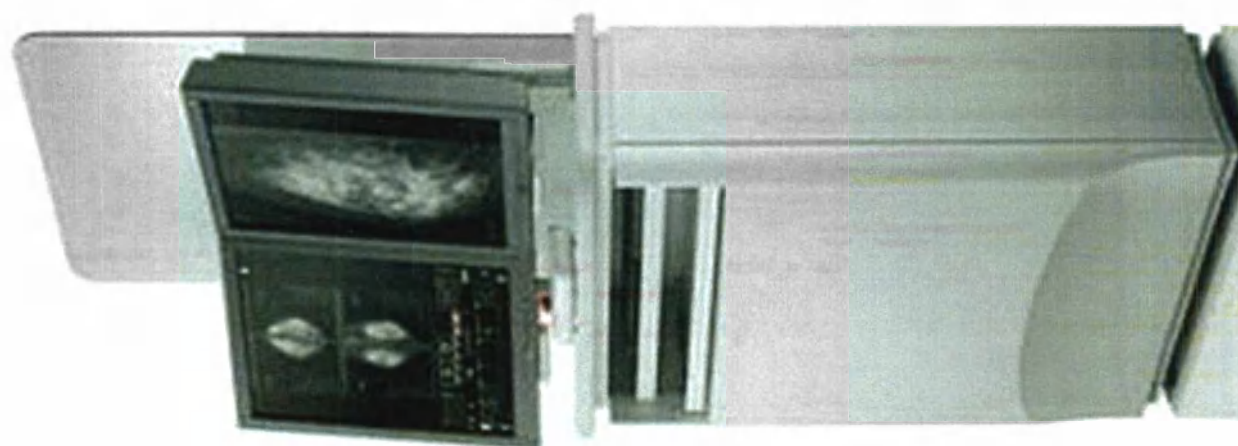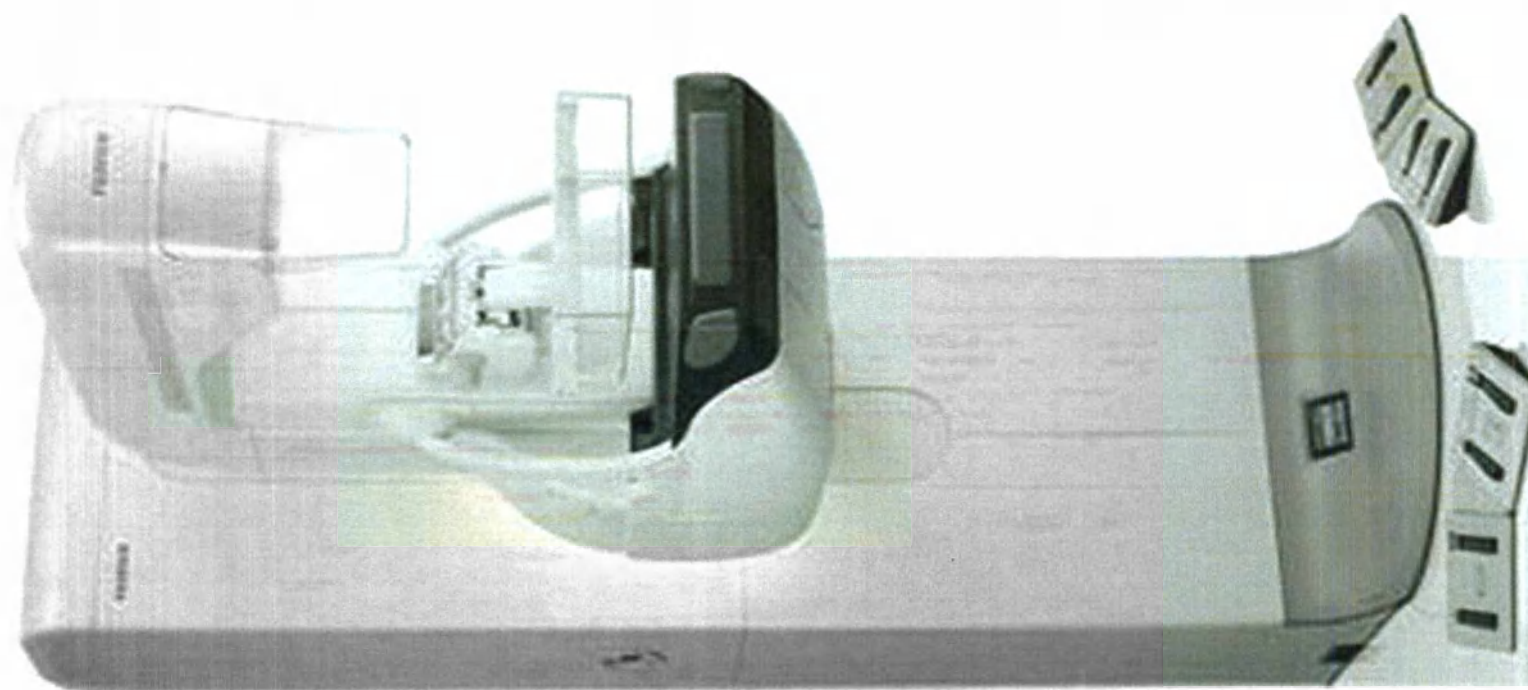

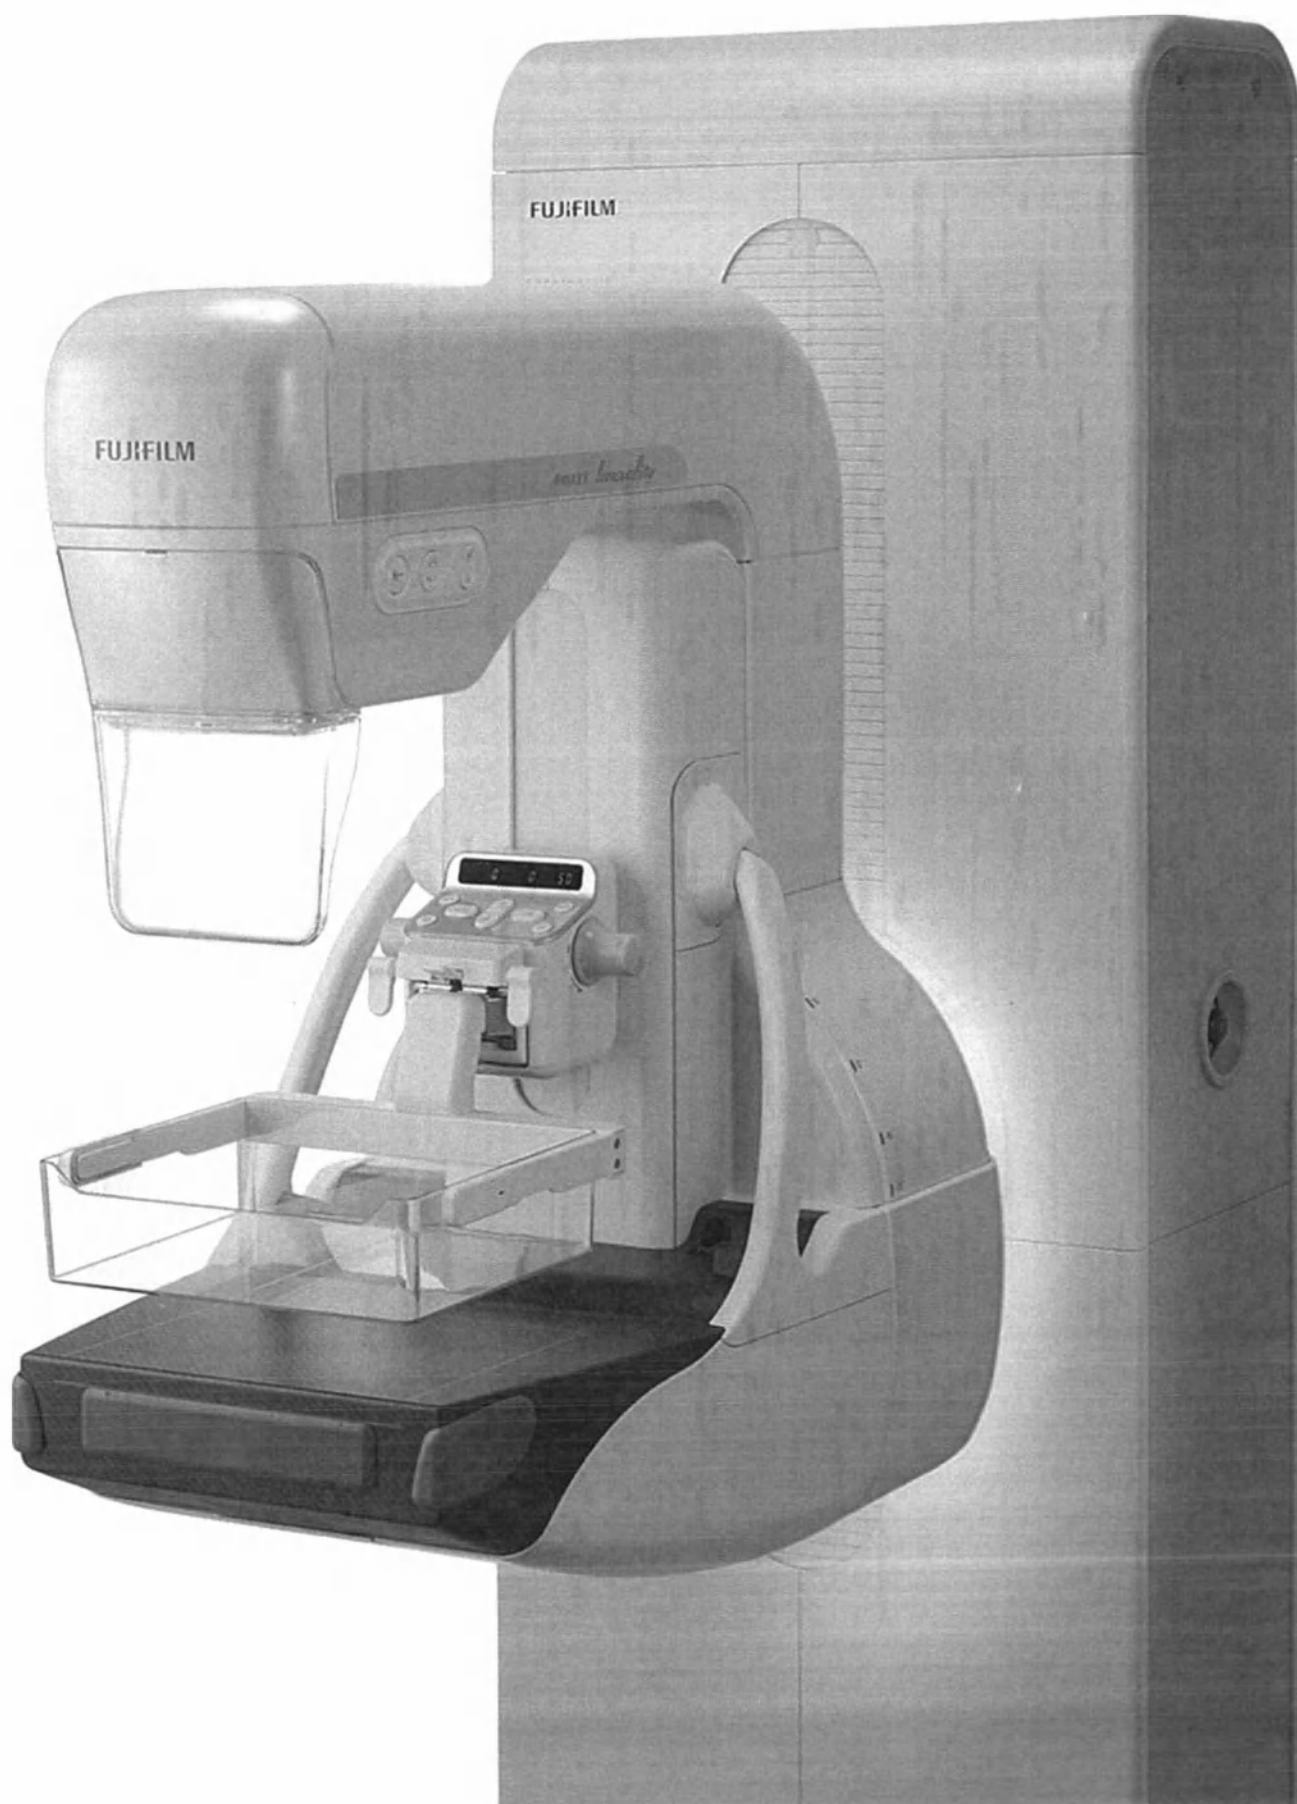


- цифровой плоскопанельный детектор (формат 24x30 см);

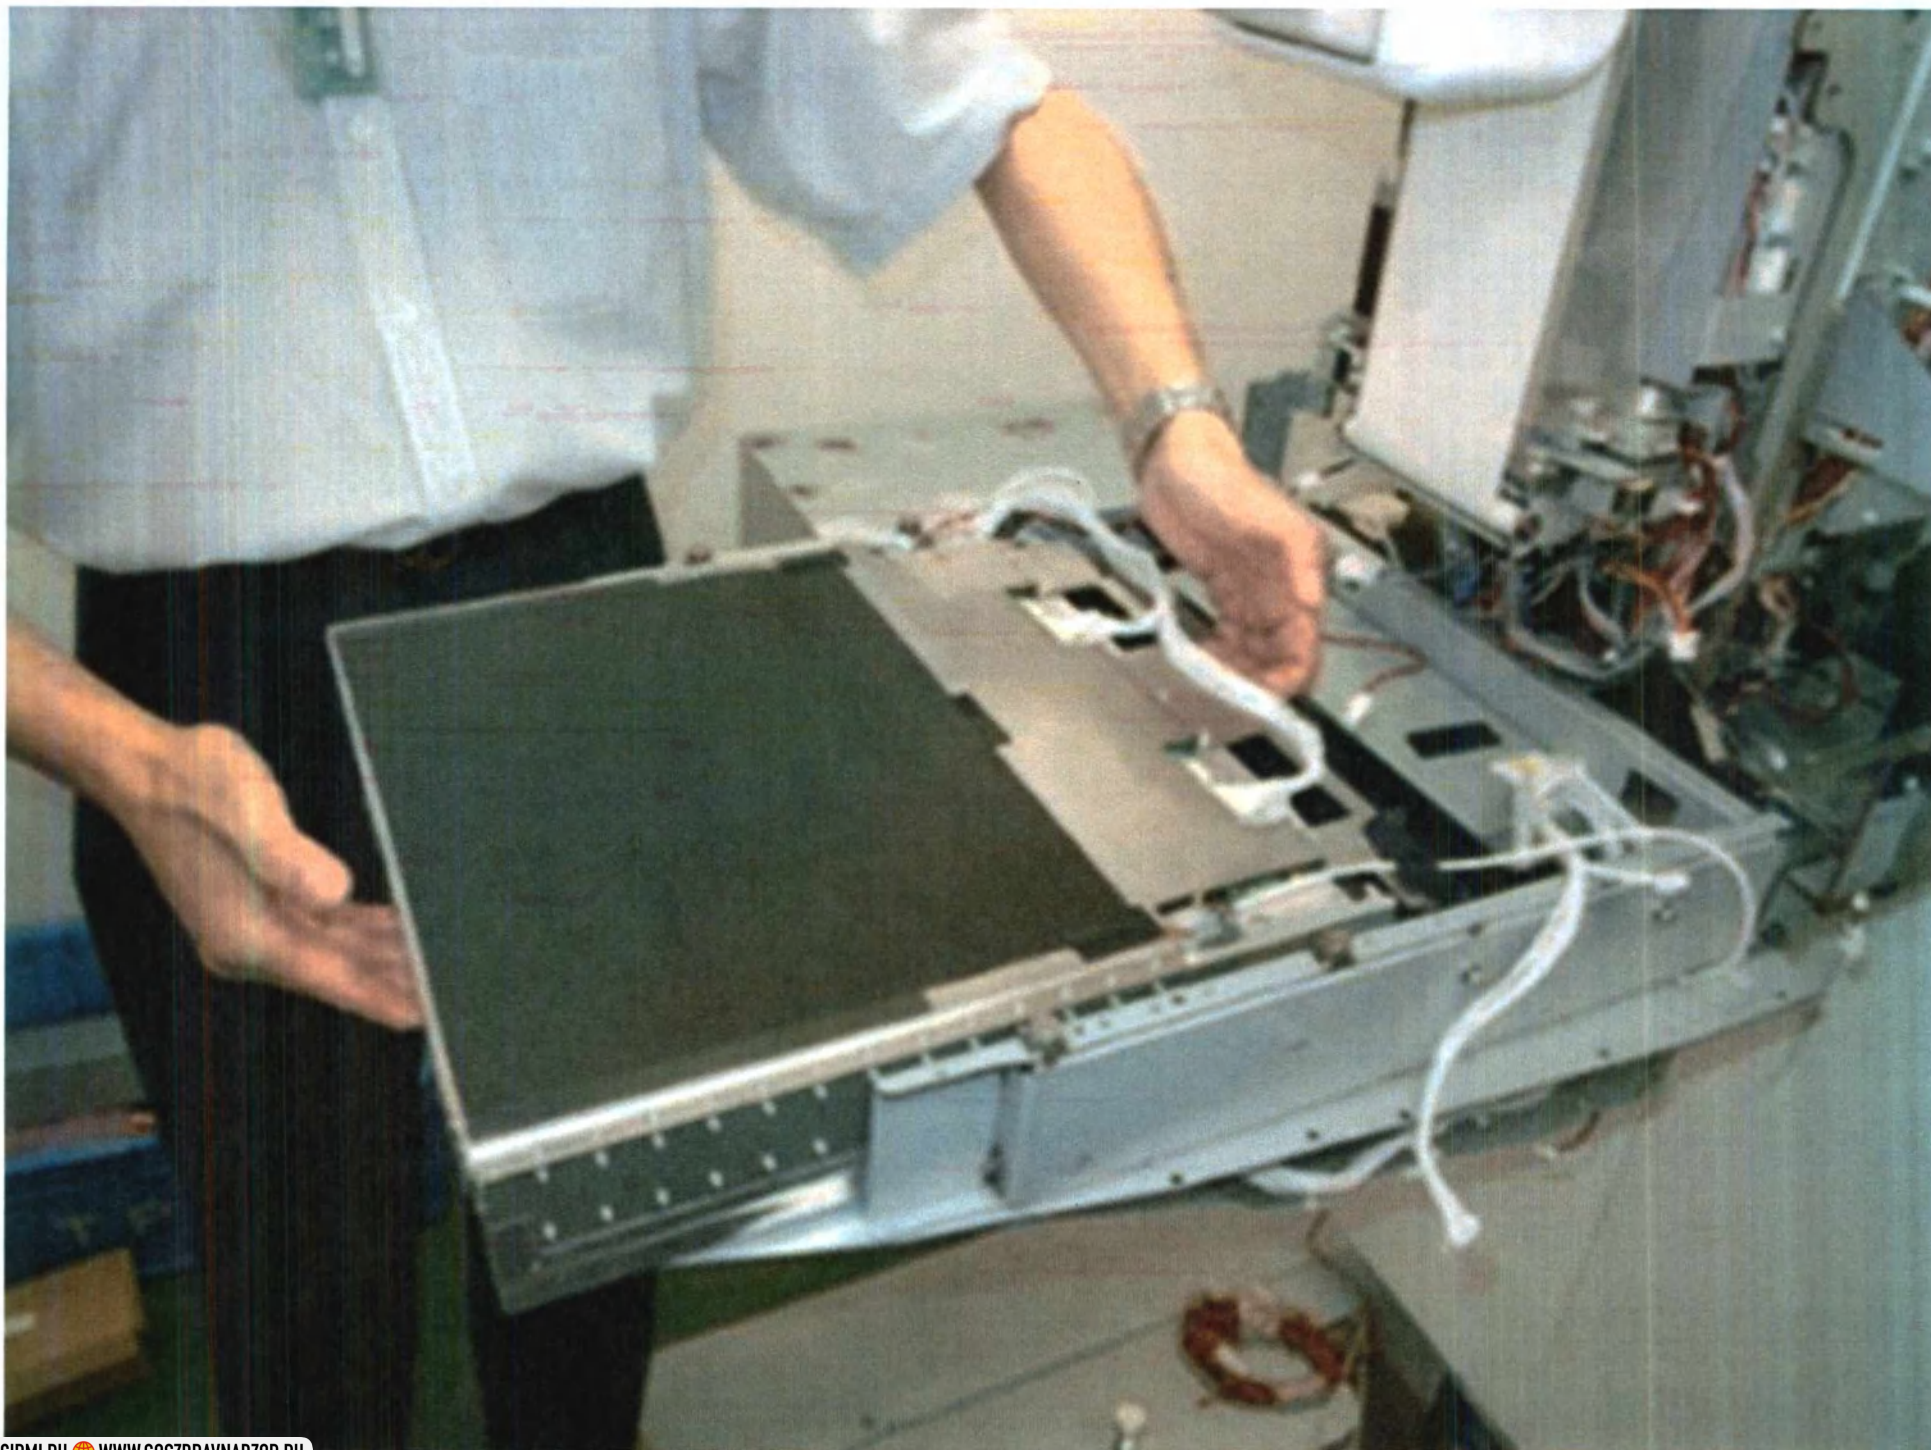


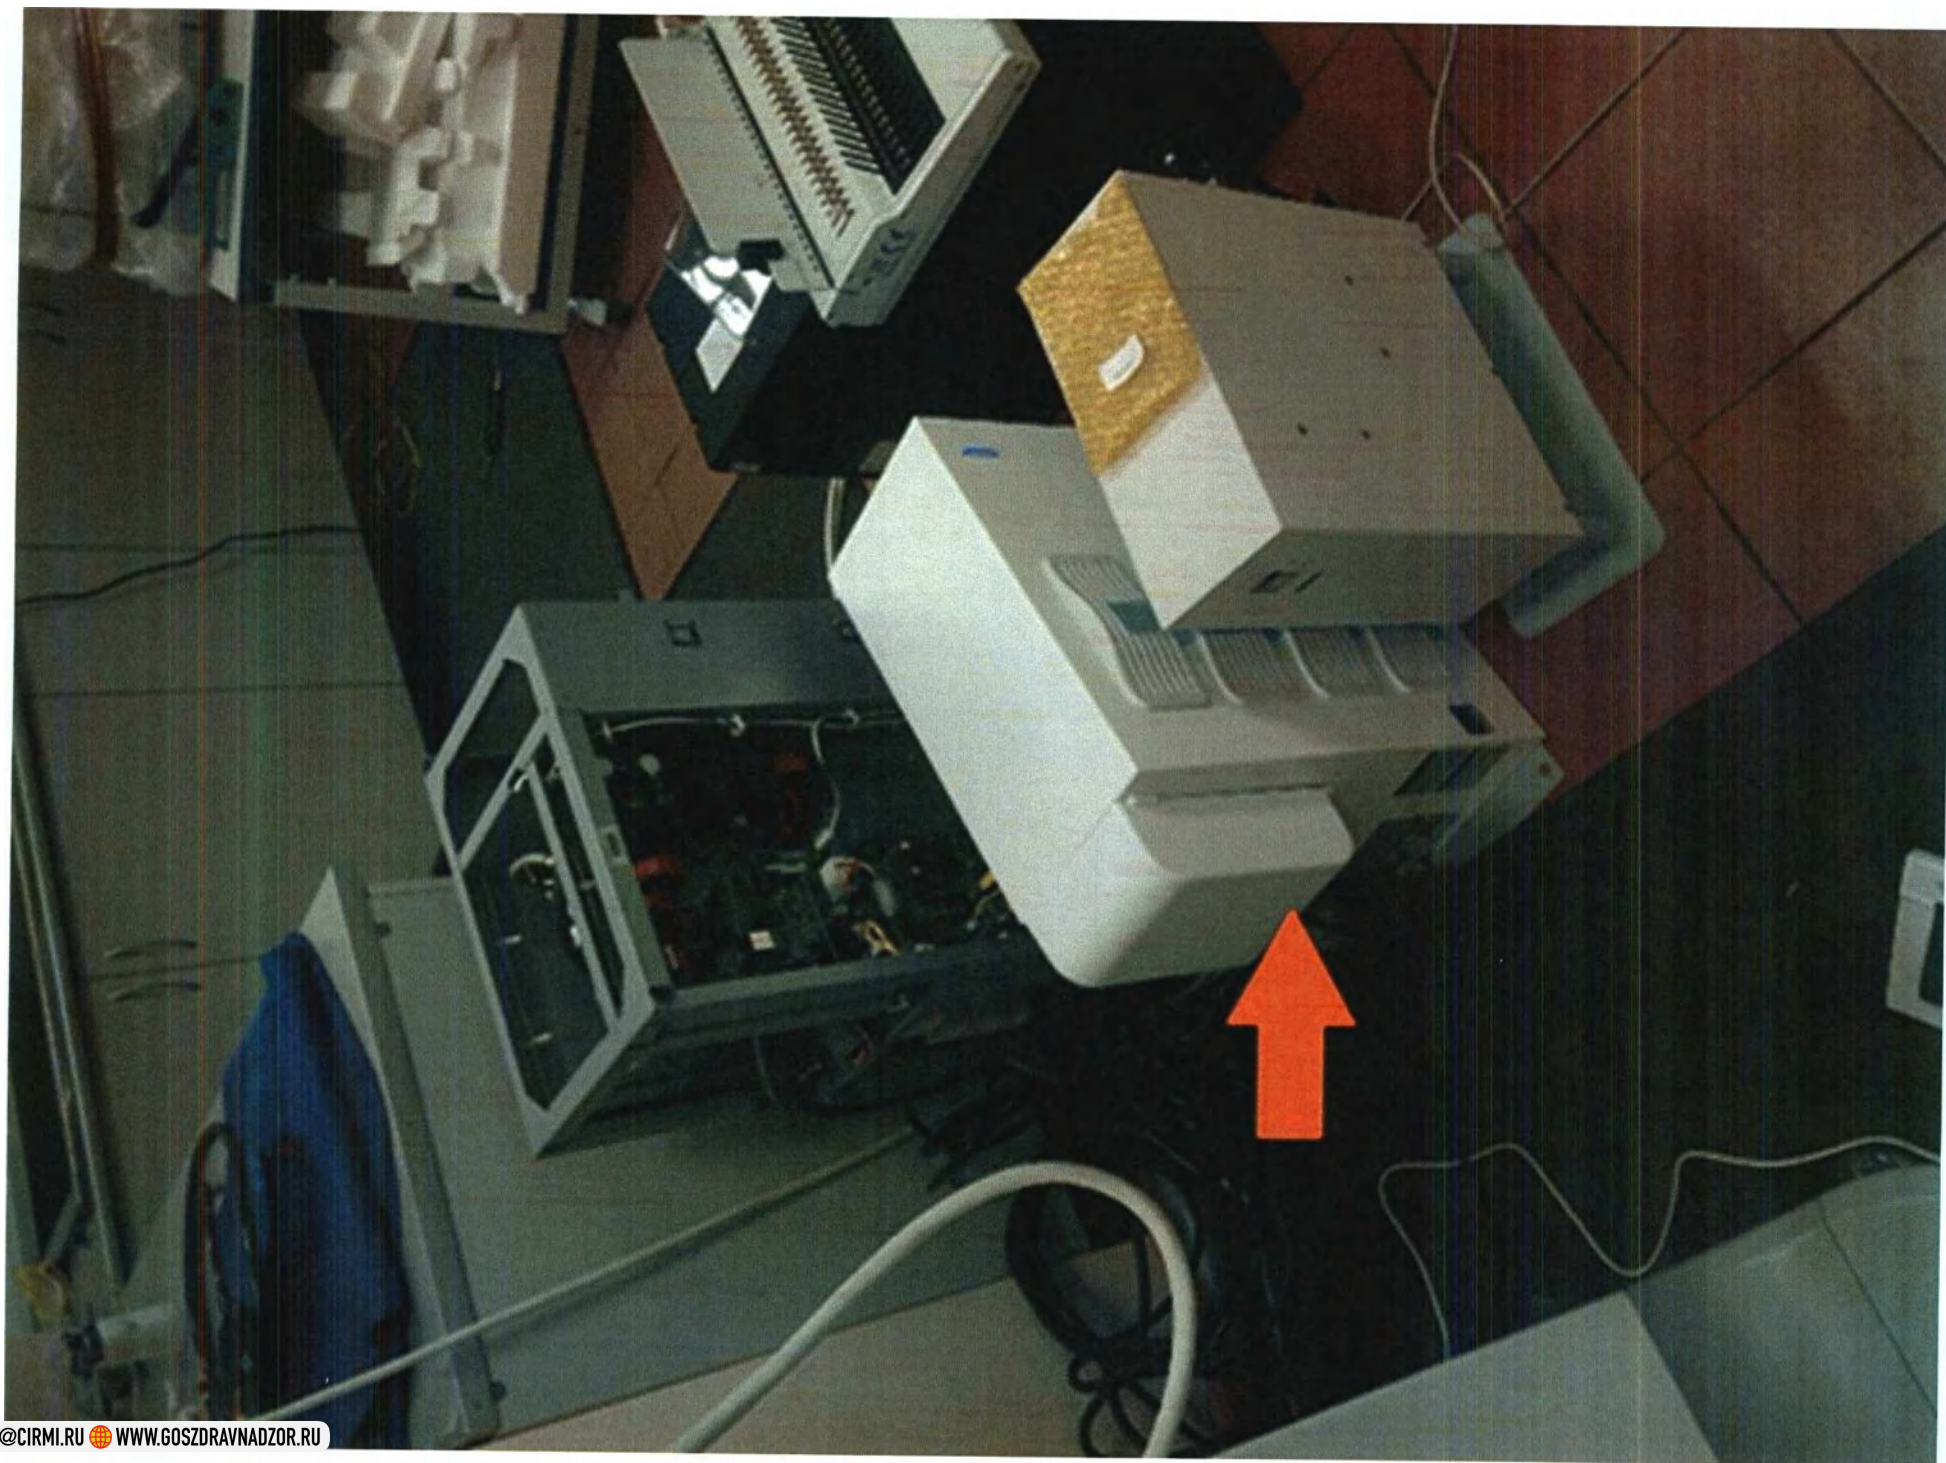


- консоль управления;



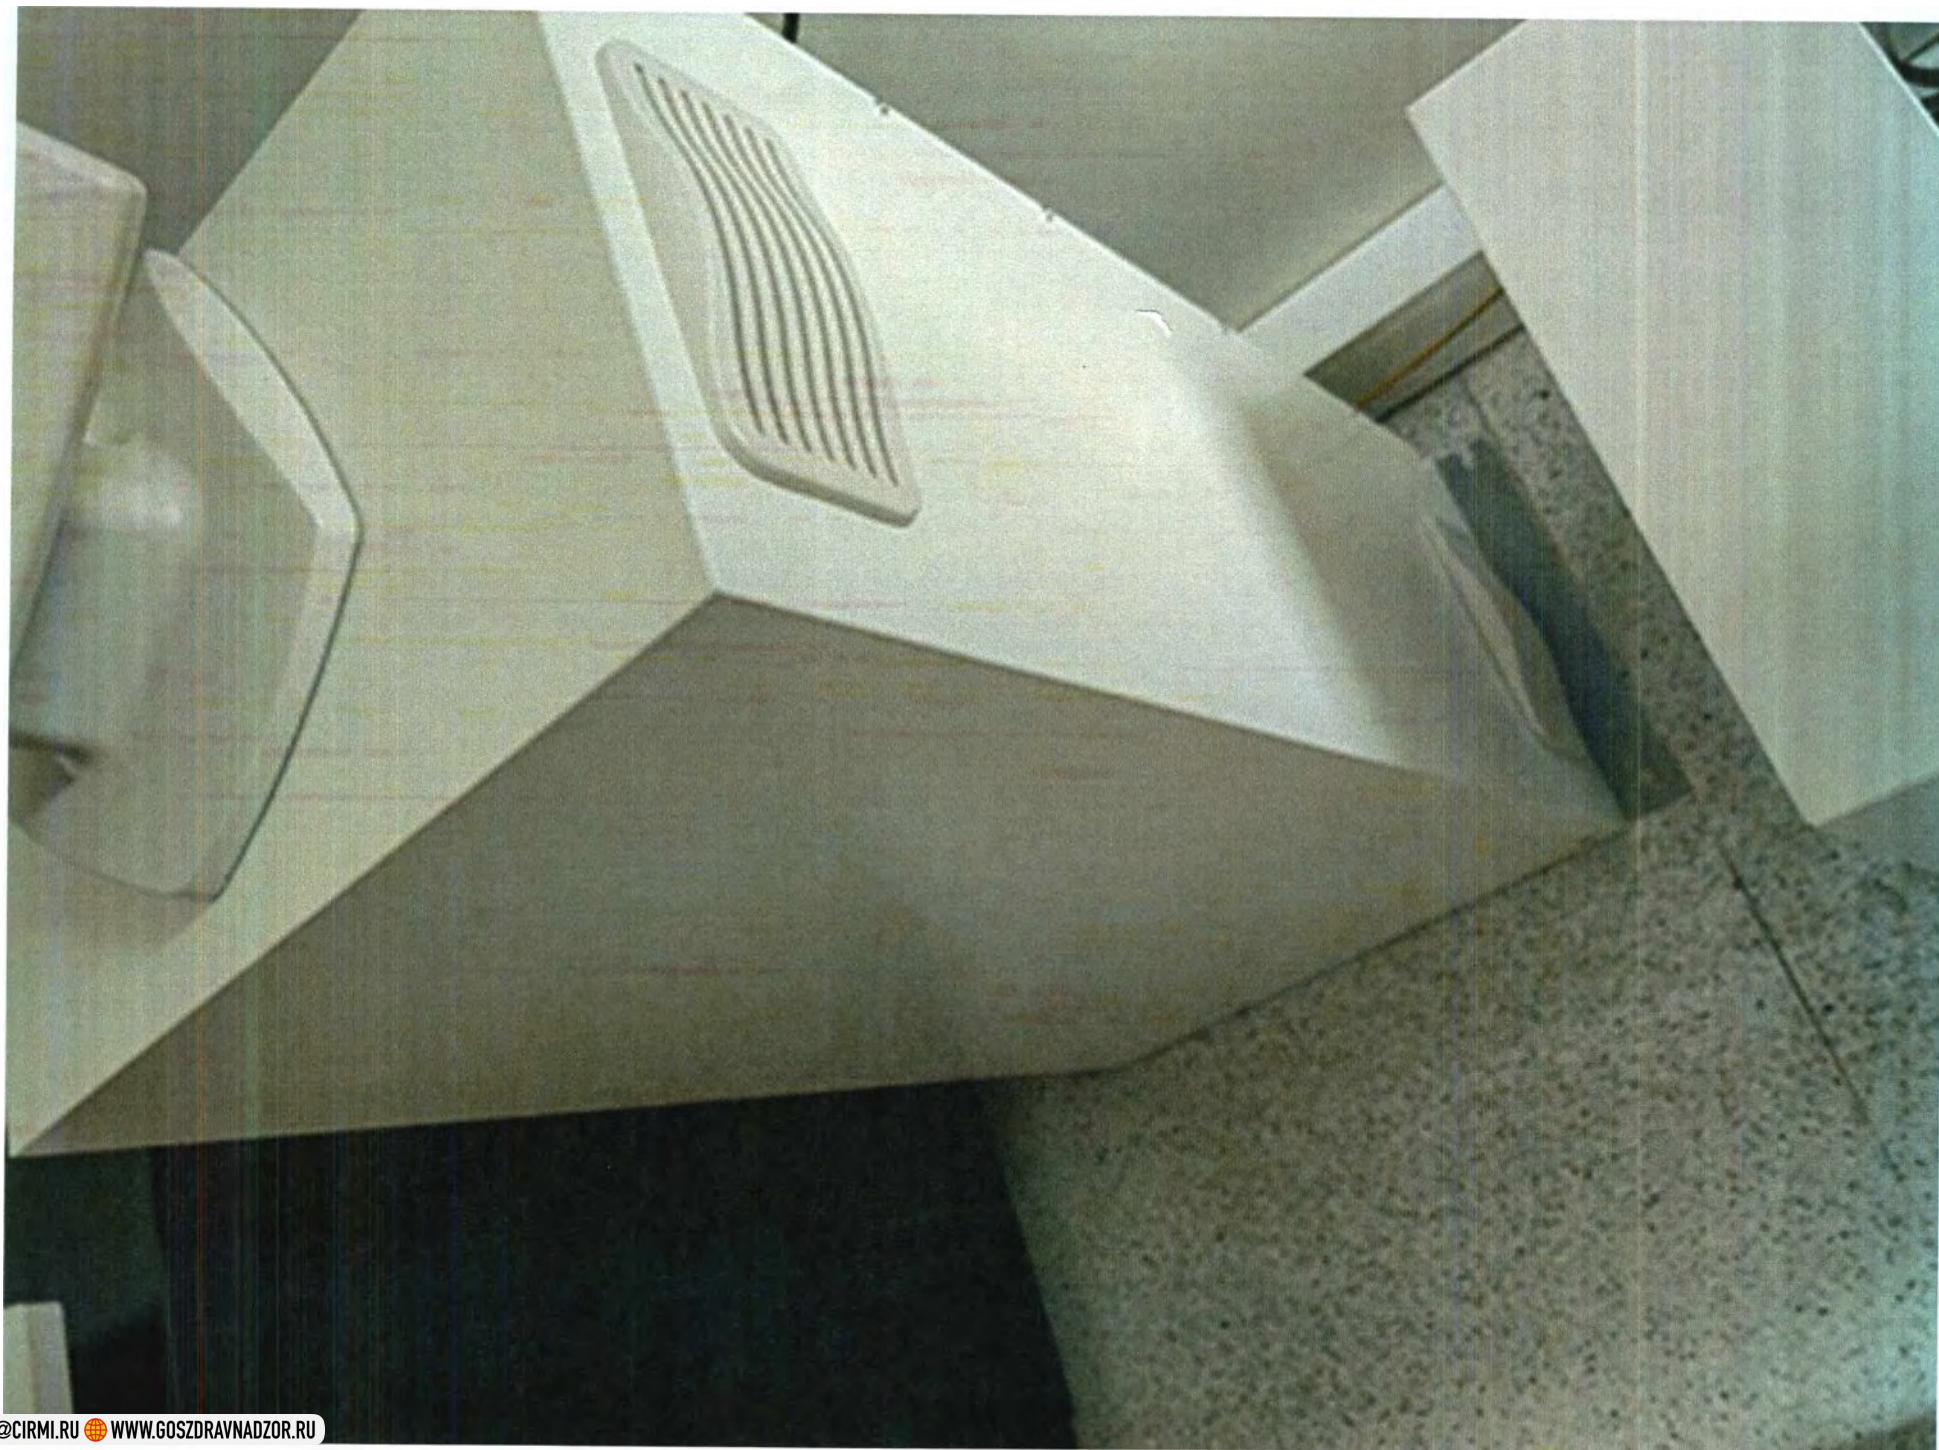


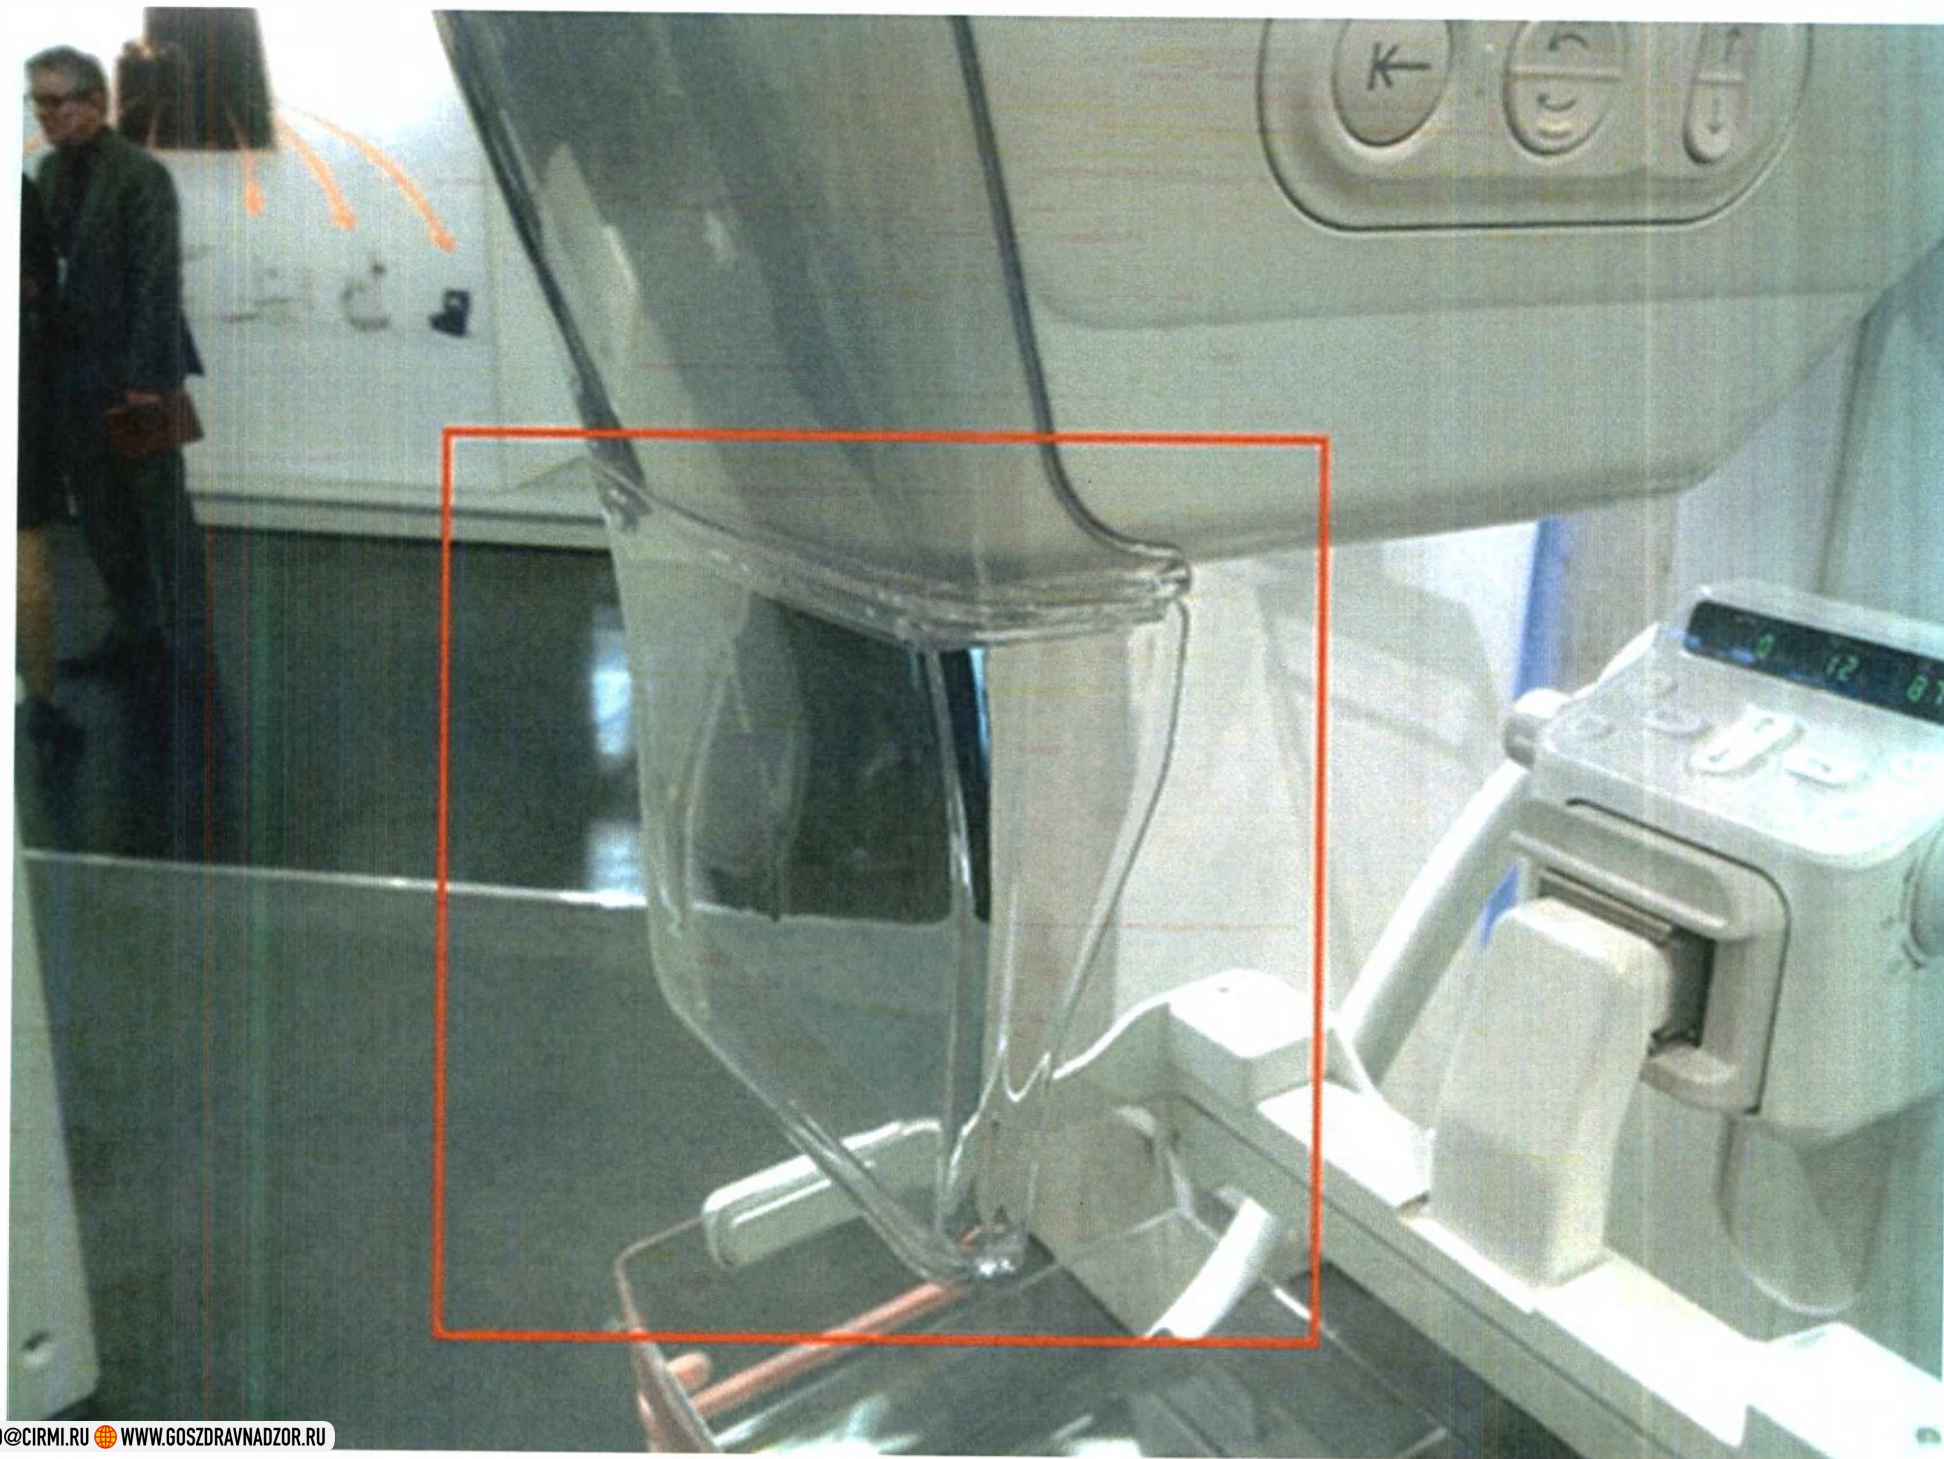


- кабель включения рентгеновской экспозиции (220 В);

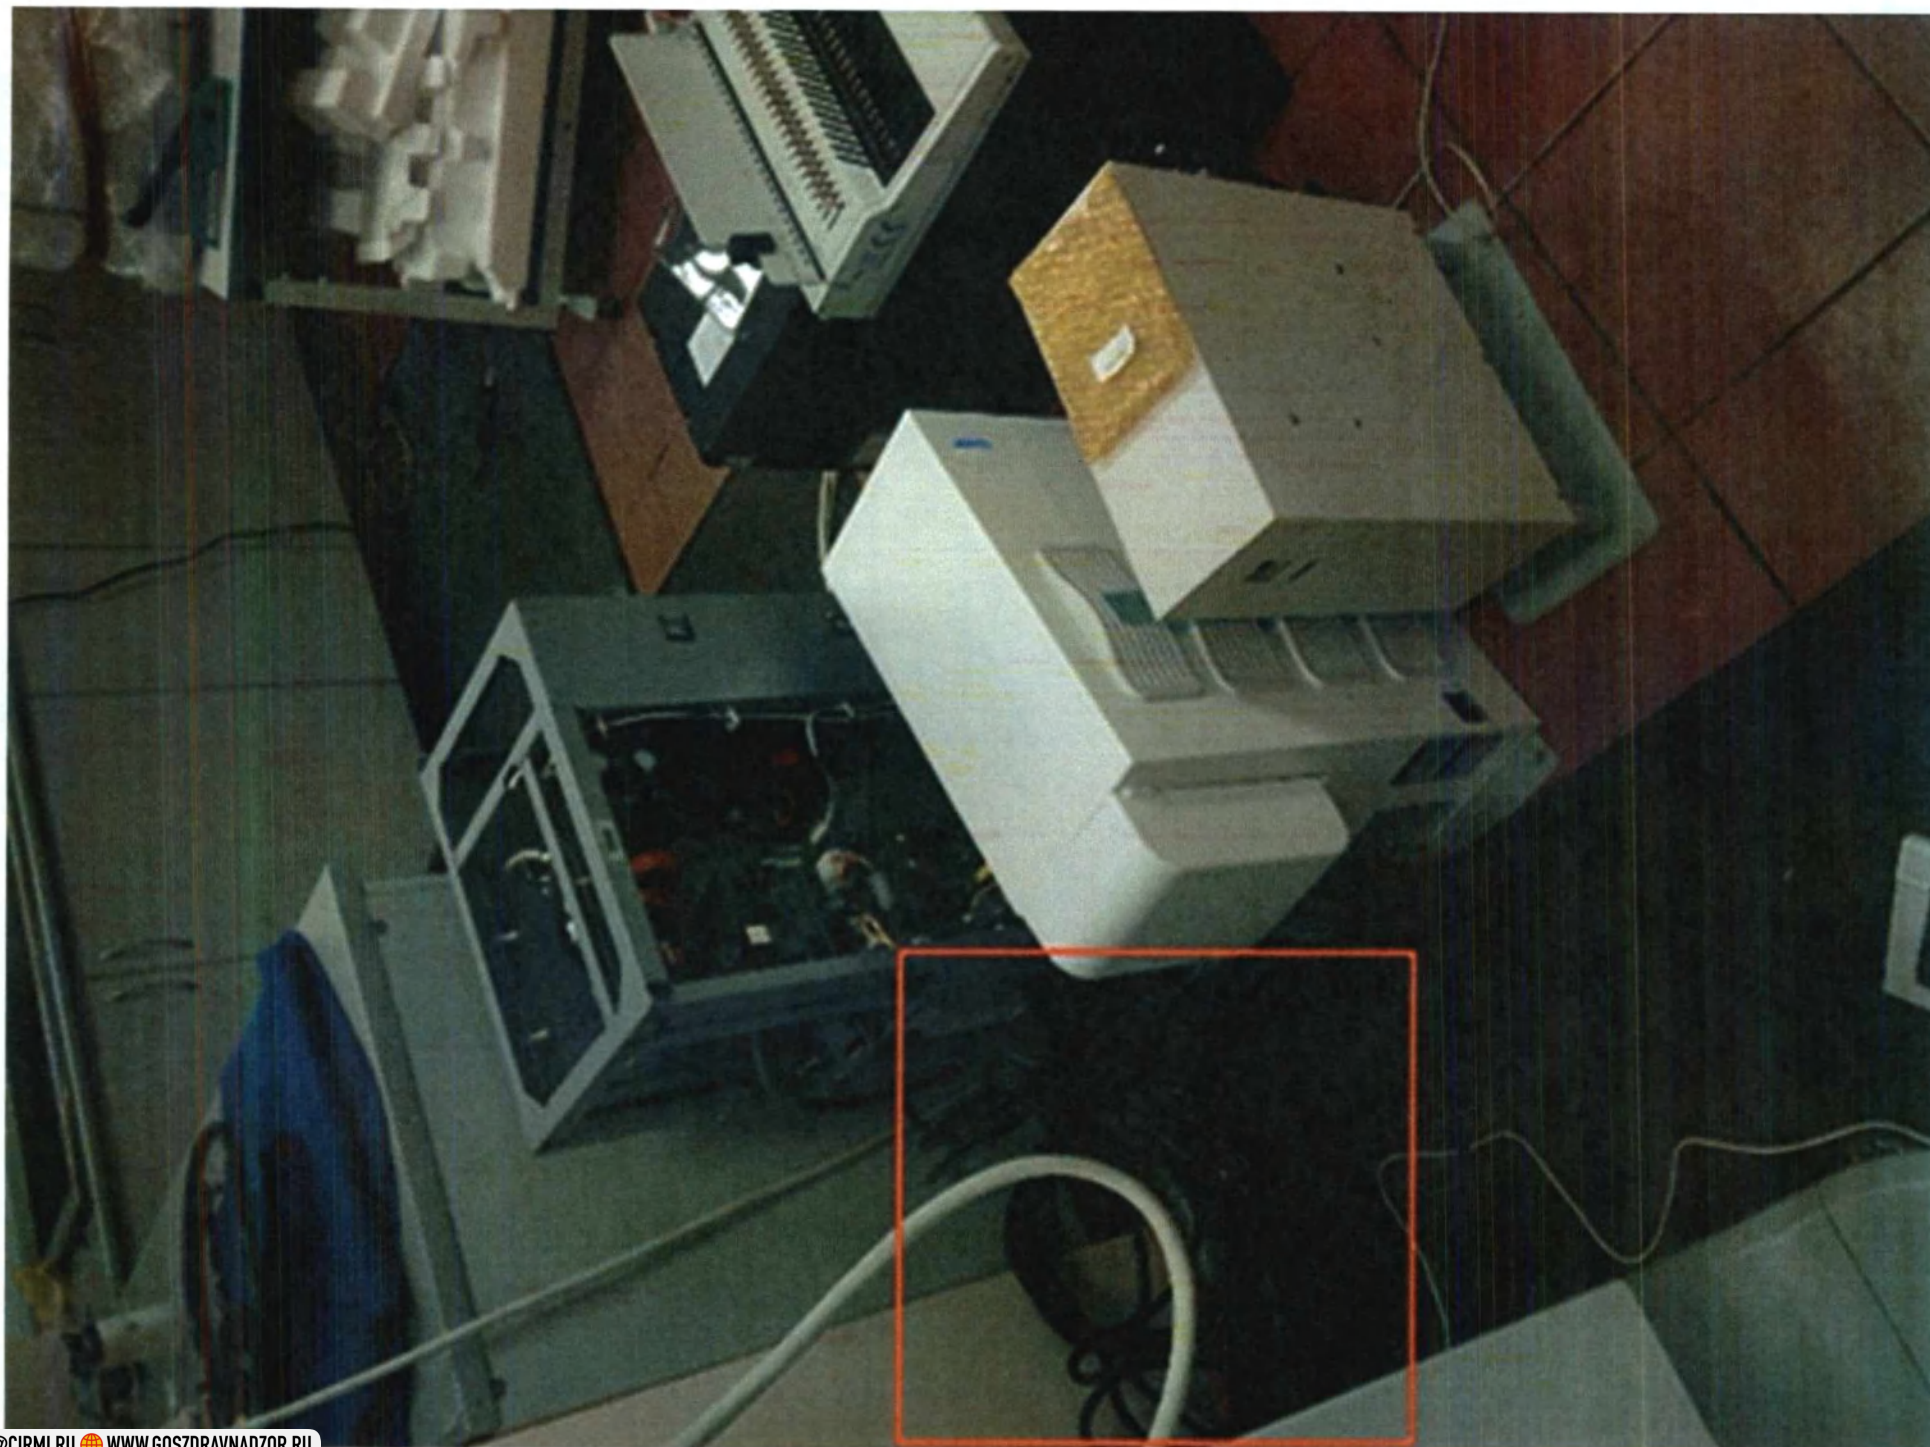


- подмышечные подкладки (левая) - 3 шт.;

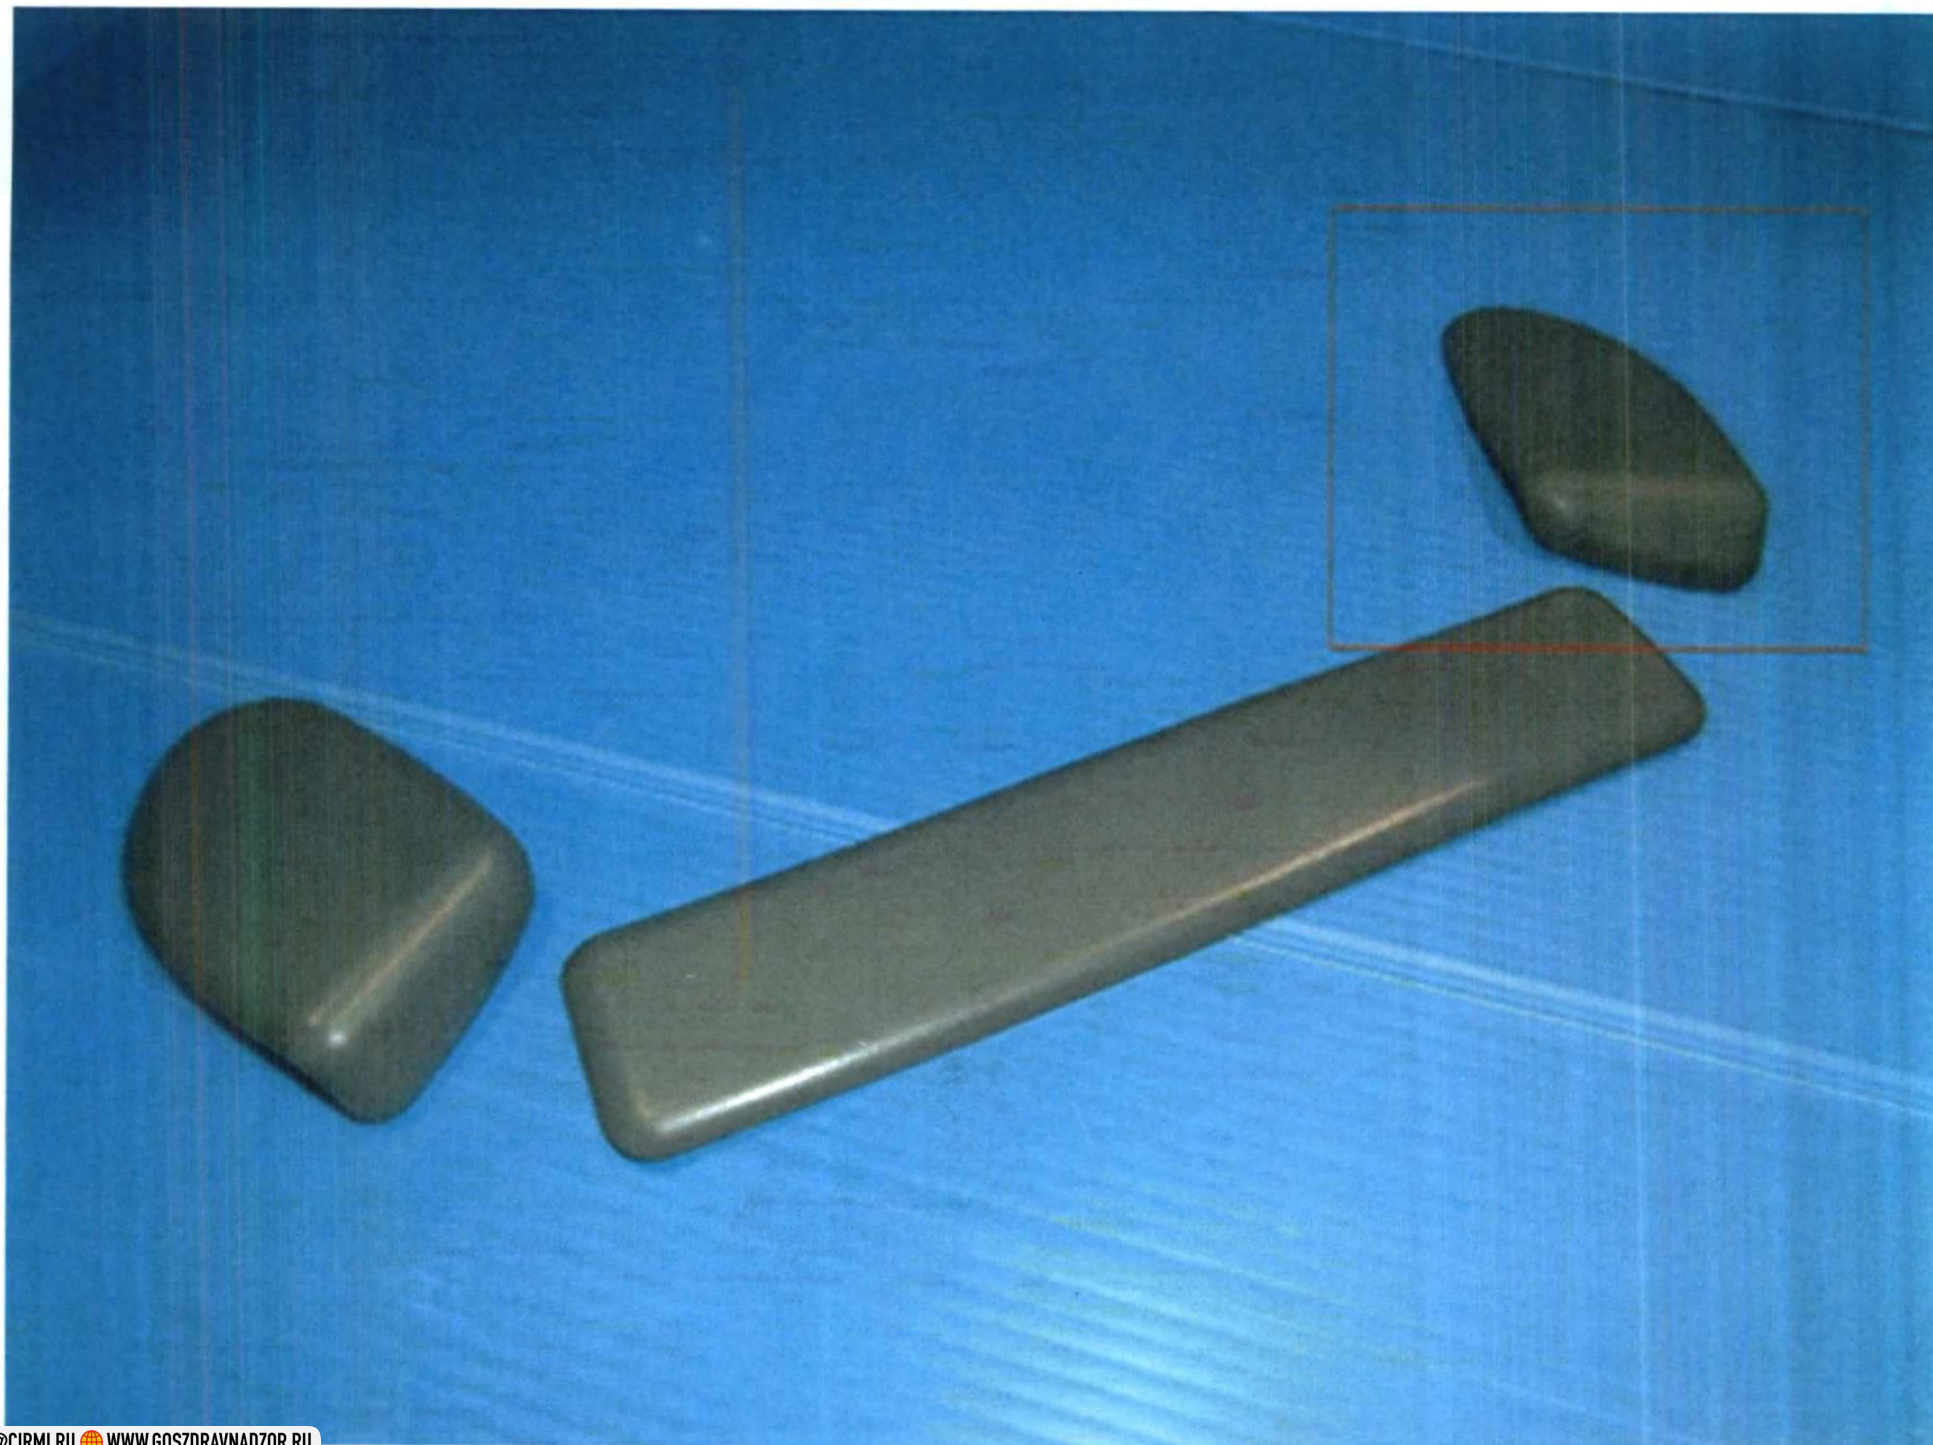


- подмышечные подкладки (правая) - 3 шт.;

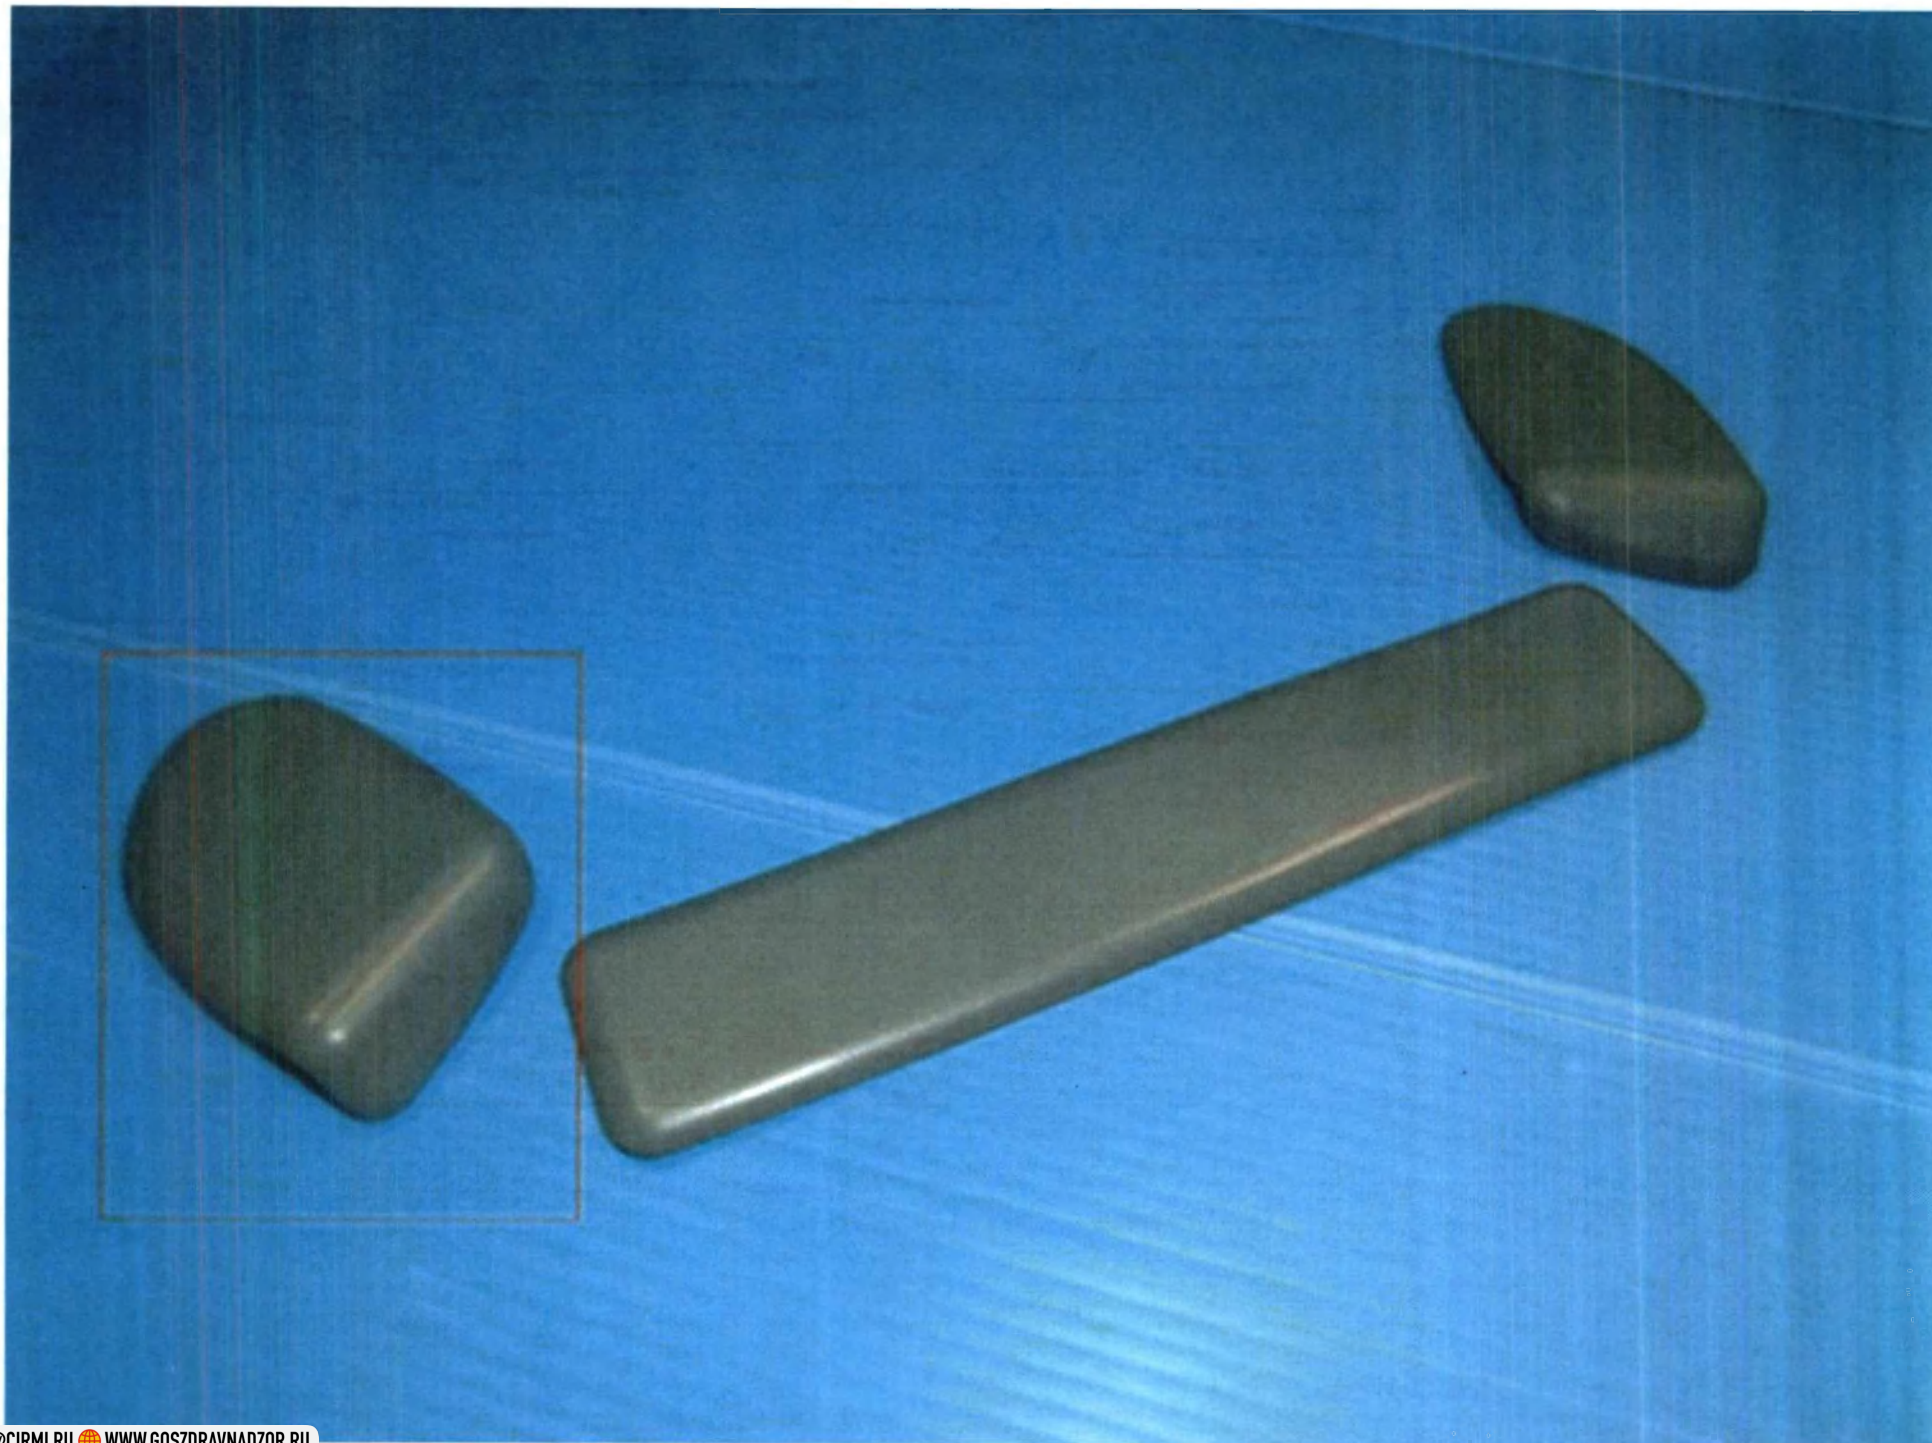

- подкладки для грудной стенки - 3 шт.;

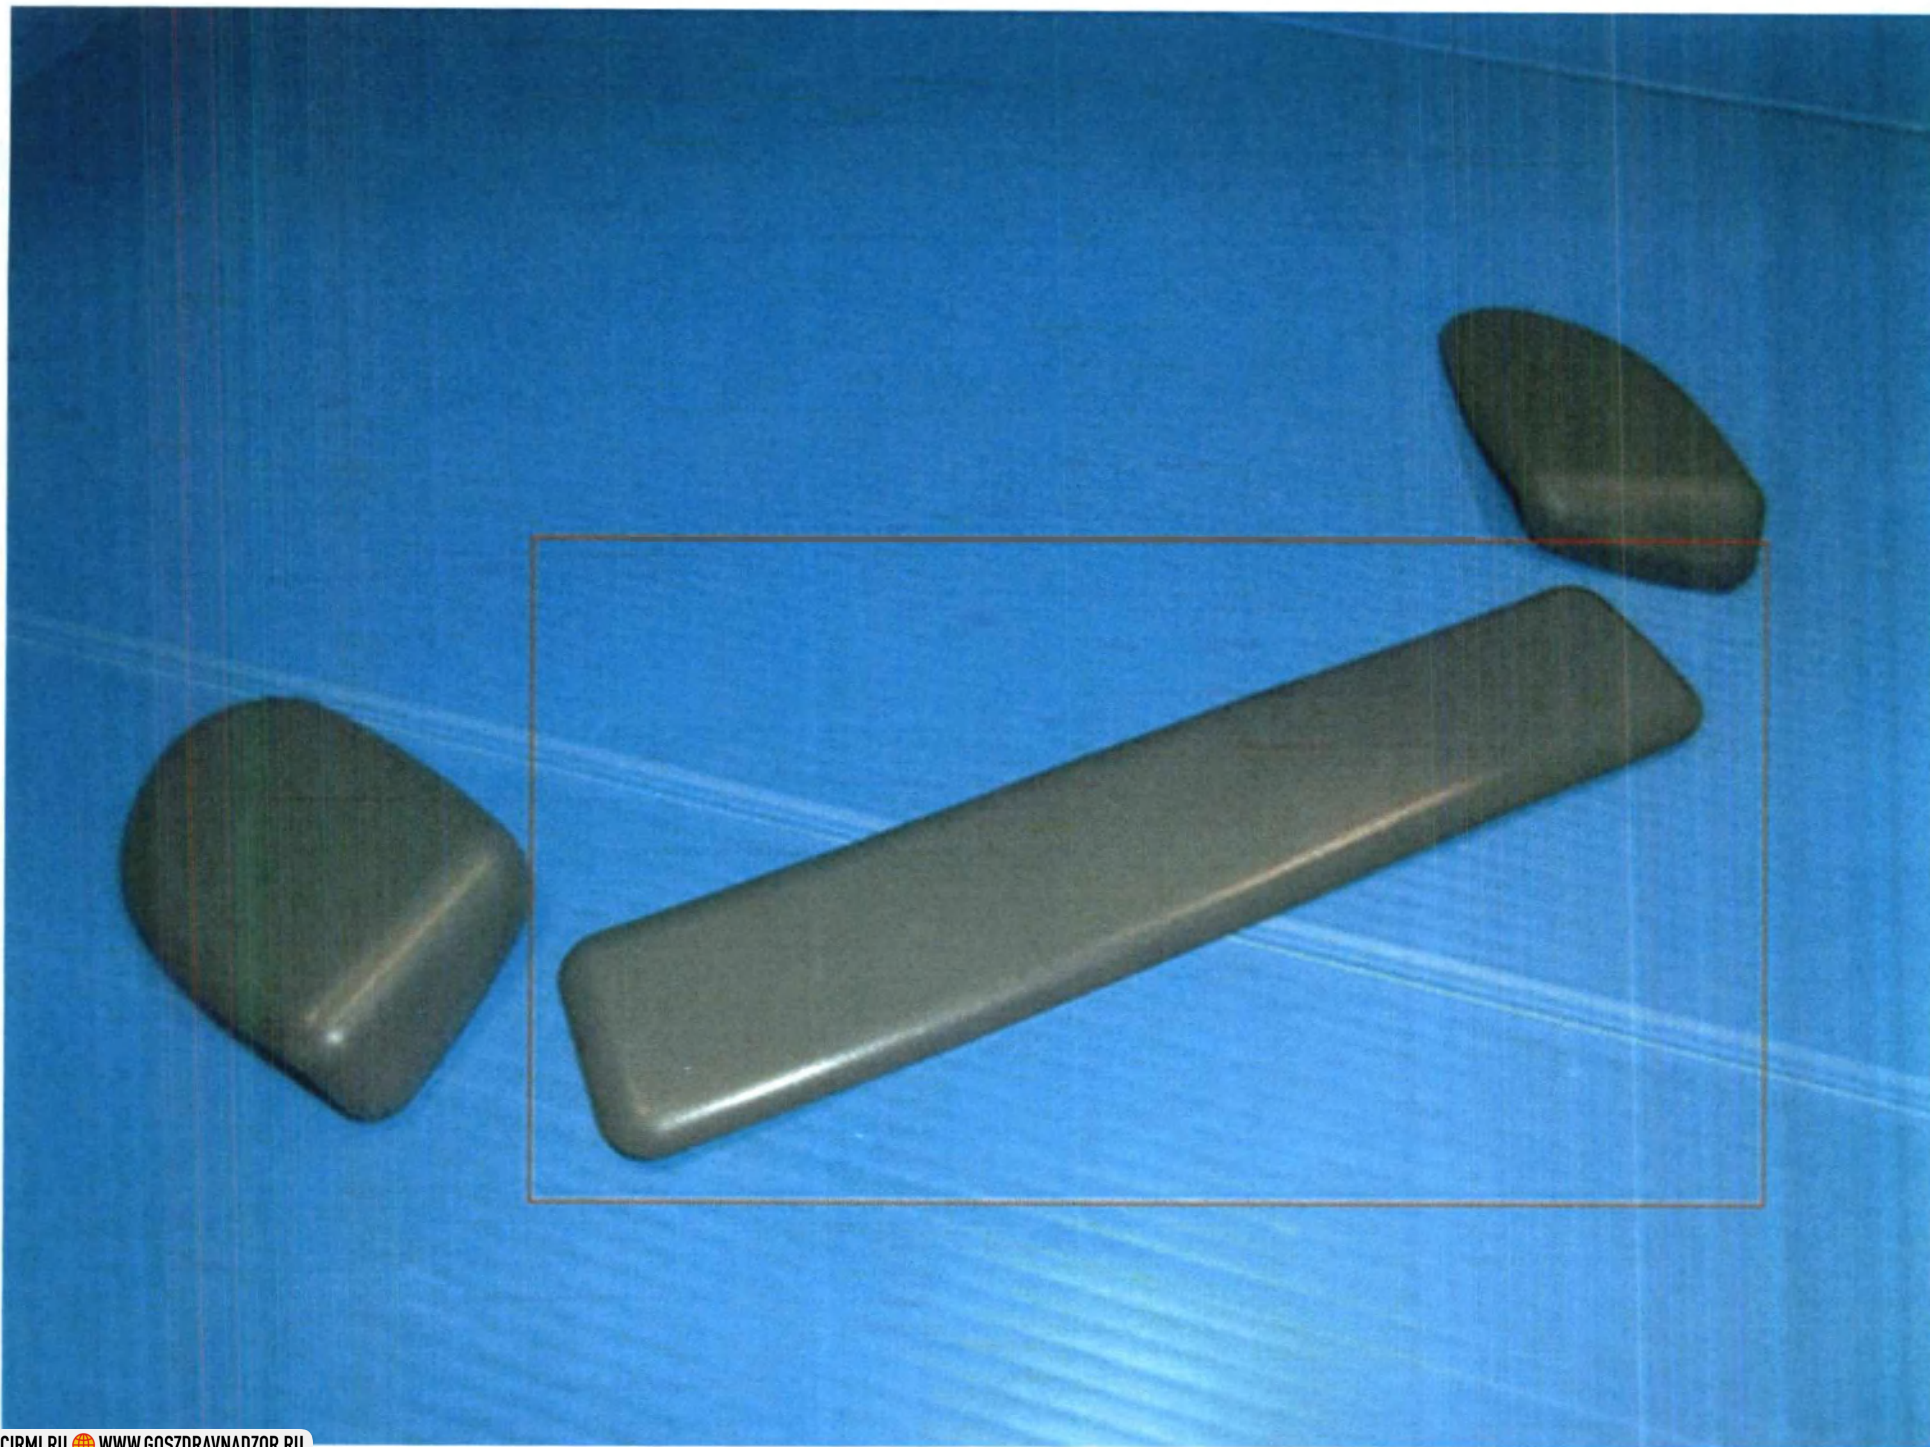


- набор предохранителей для монтажной платы;

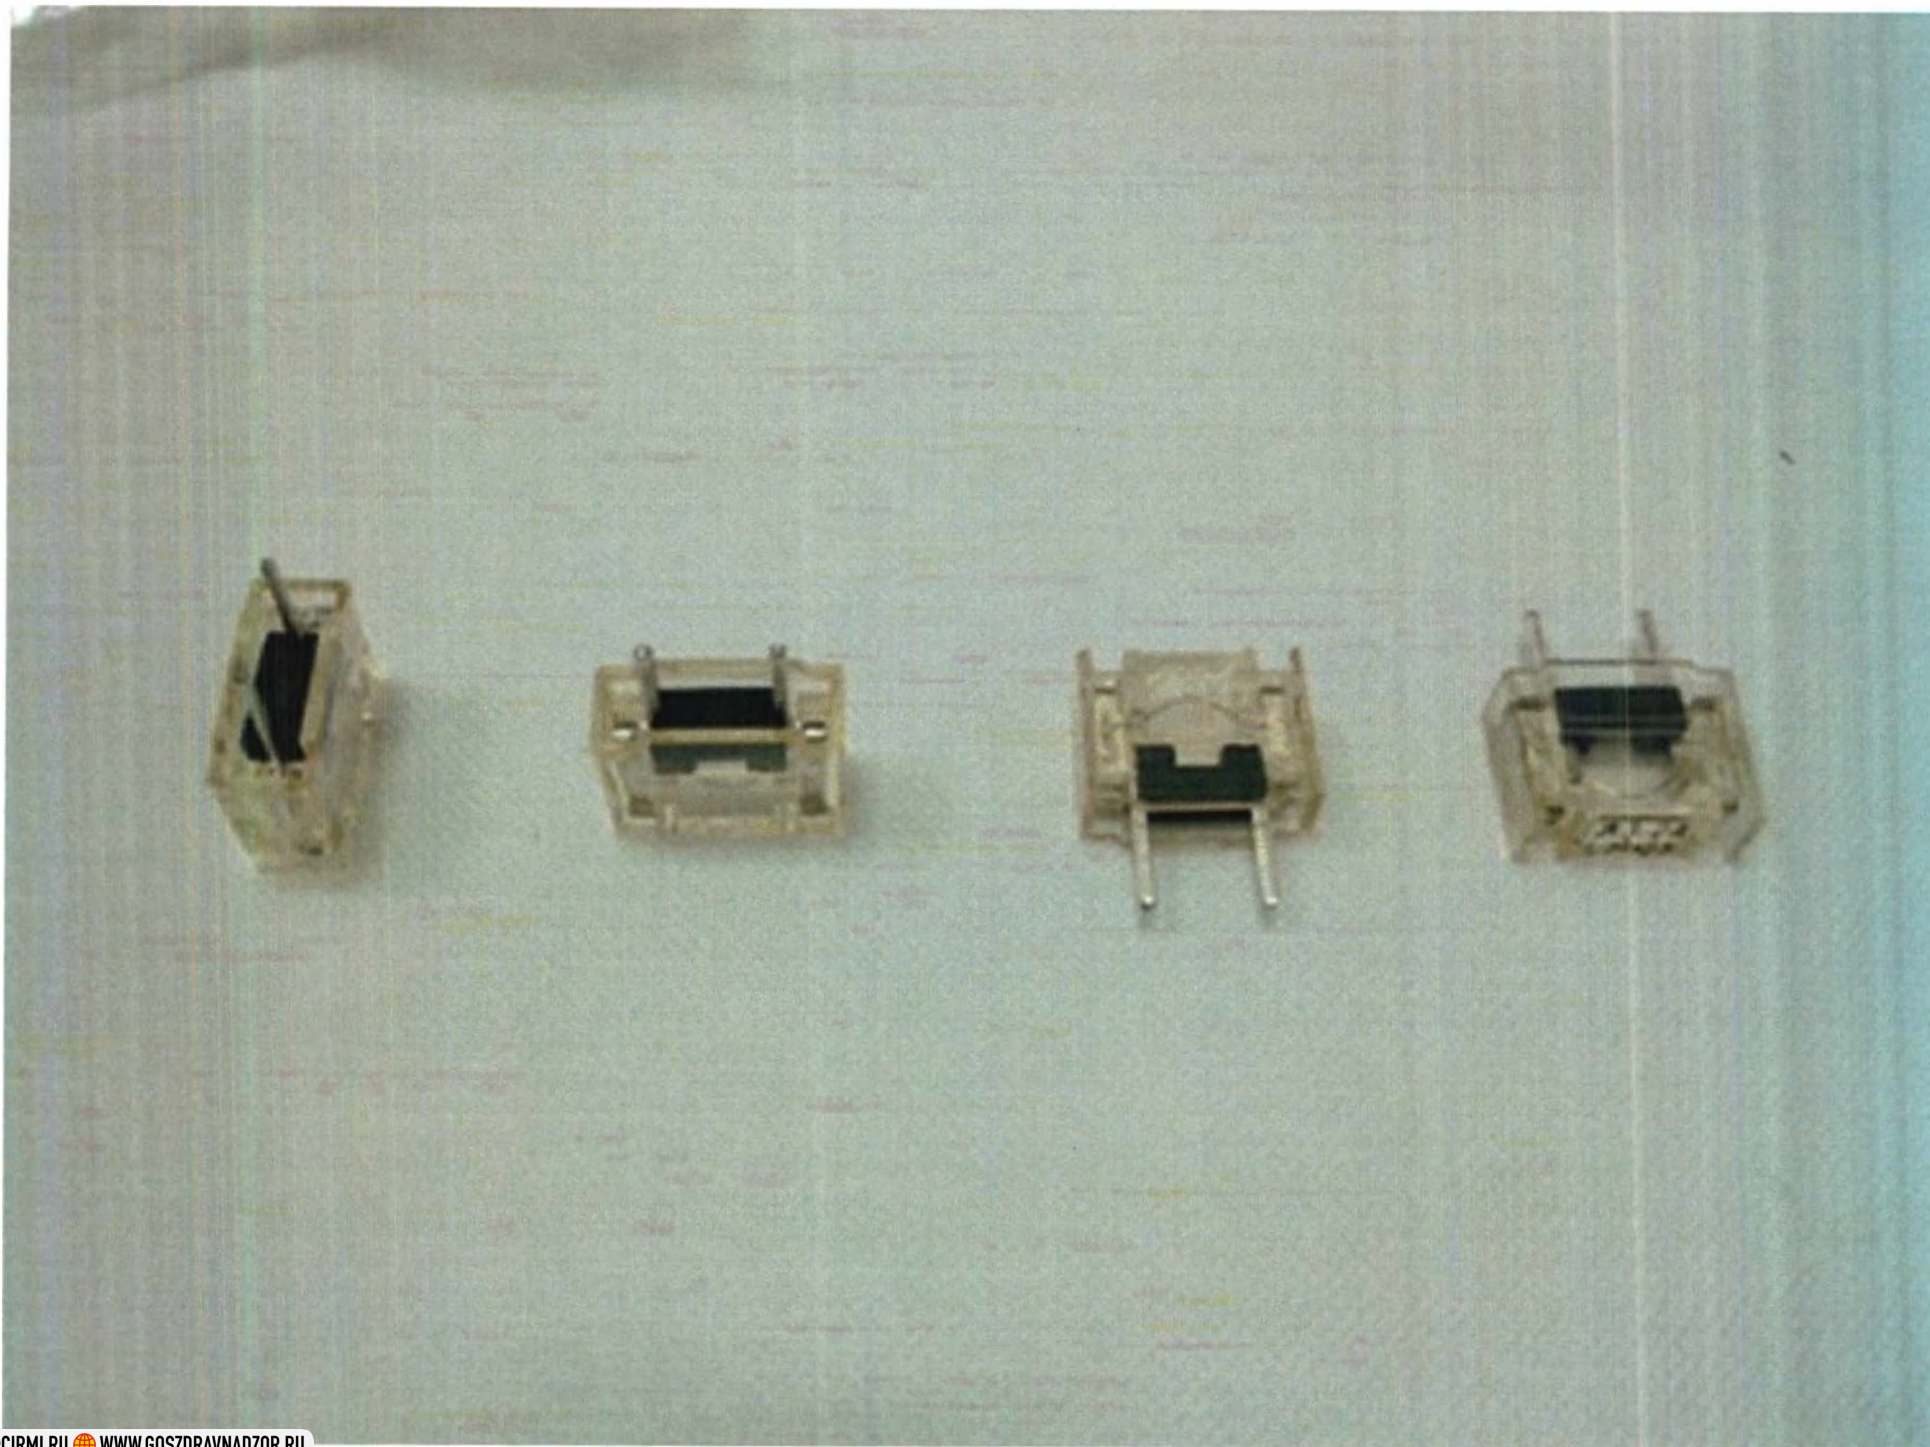


2. Рабочая станция лаборанта (FDR-3000AWS) для сбора и анализа медицинских диагностических изображений:
- устройство сбора и анализа изображений; - клавиатура; - мышь; - кабели питания (220 В), не более 5 шт., сетевой концентратор

15

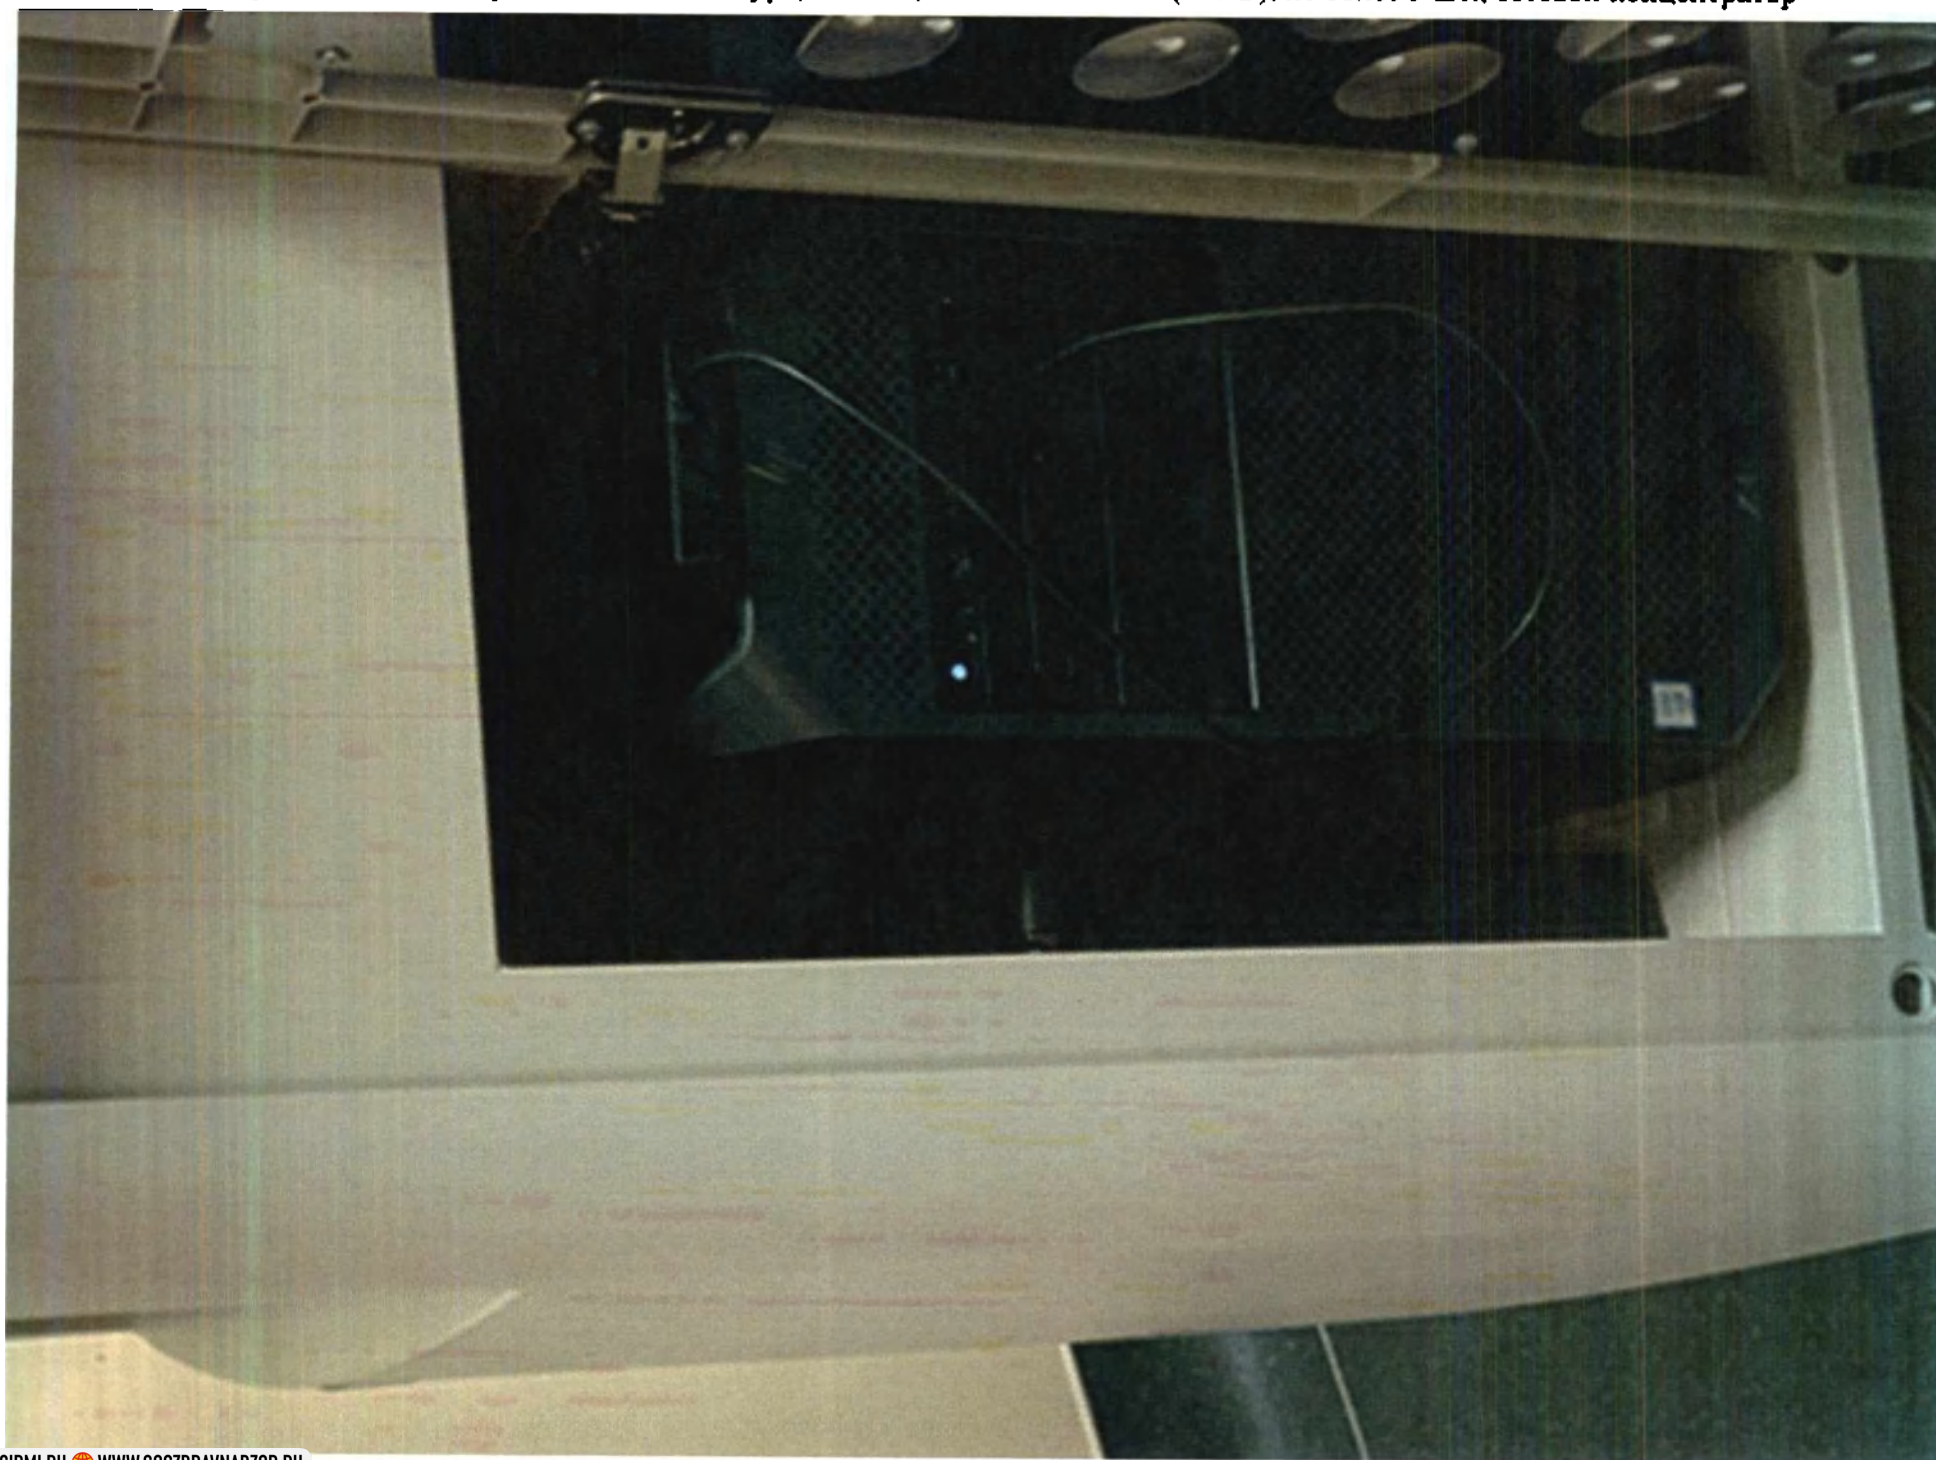

Принадлежности: 1. Рабочая станция врача для сбора и анализа медицинских диагностических изображений, не более 5 шт.:
- устройство сбора и анализа изображений; - клавиатура; - мышь; - кабели питания (220 В), не более 5 шт. 16

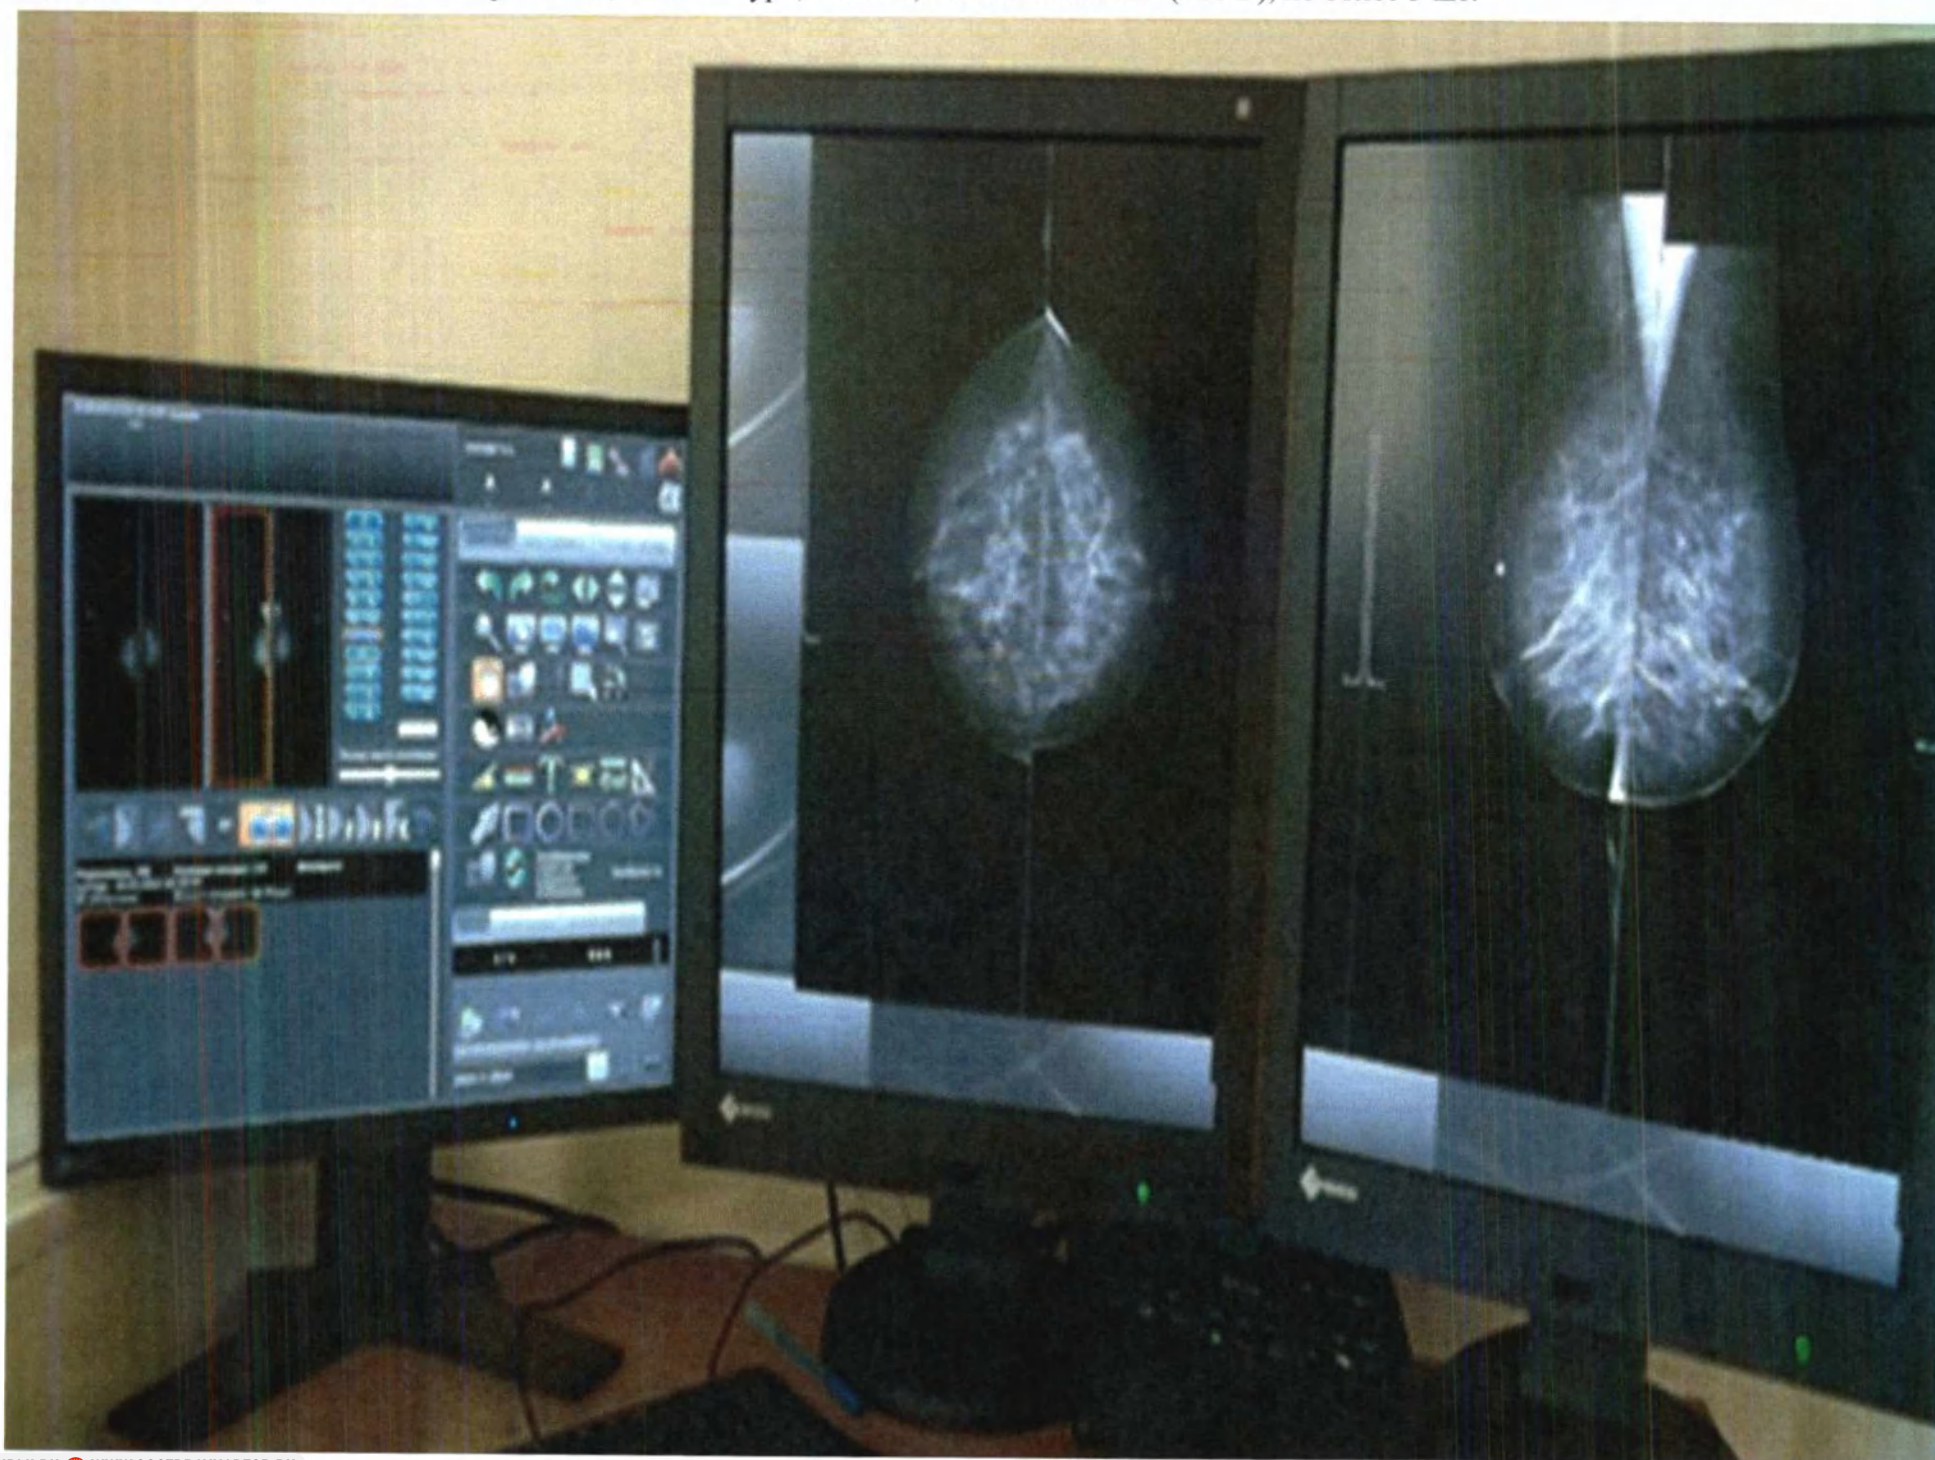

Принадлежности: 1. Рабочая станция врача для сбора и анализа медицинских диагностических изображений, не более 5 шт.: 17
- устройство сбора и анализа изображений; - клавиатура; - мышь; - кабели питания (220 В), не более 5 шт.



2. Медицинские LCD-мониторы рабочей станции лаборанта для отображения данных исследования и служебной информации - не более 2 шт.



3. Медицинские LCD-мониторы рабочей станции лаборанта для отображения изображений в диагностическом качестве – не более 2 шт.



4. Кронштейн LCD-монитора для рабочей станции лаборанта - не более 2 шт.



5. Медицинские LCD-мониторы для рабочей станции врача - не более 10 шт.



6. Медицинские LCD-мониторы (сдвоенные) для рабочей станции врача - не более 6 шт.




7. LCD-мониторы просмотра листа пациентов и служебной информации для рабочей станции врача - не более 10 шт.



8. Пульты управления специализированные для рабочей станции врача — не более 5 шт.



9. Переключатели двойные ножные - 2 шт.

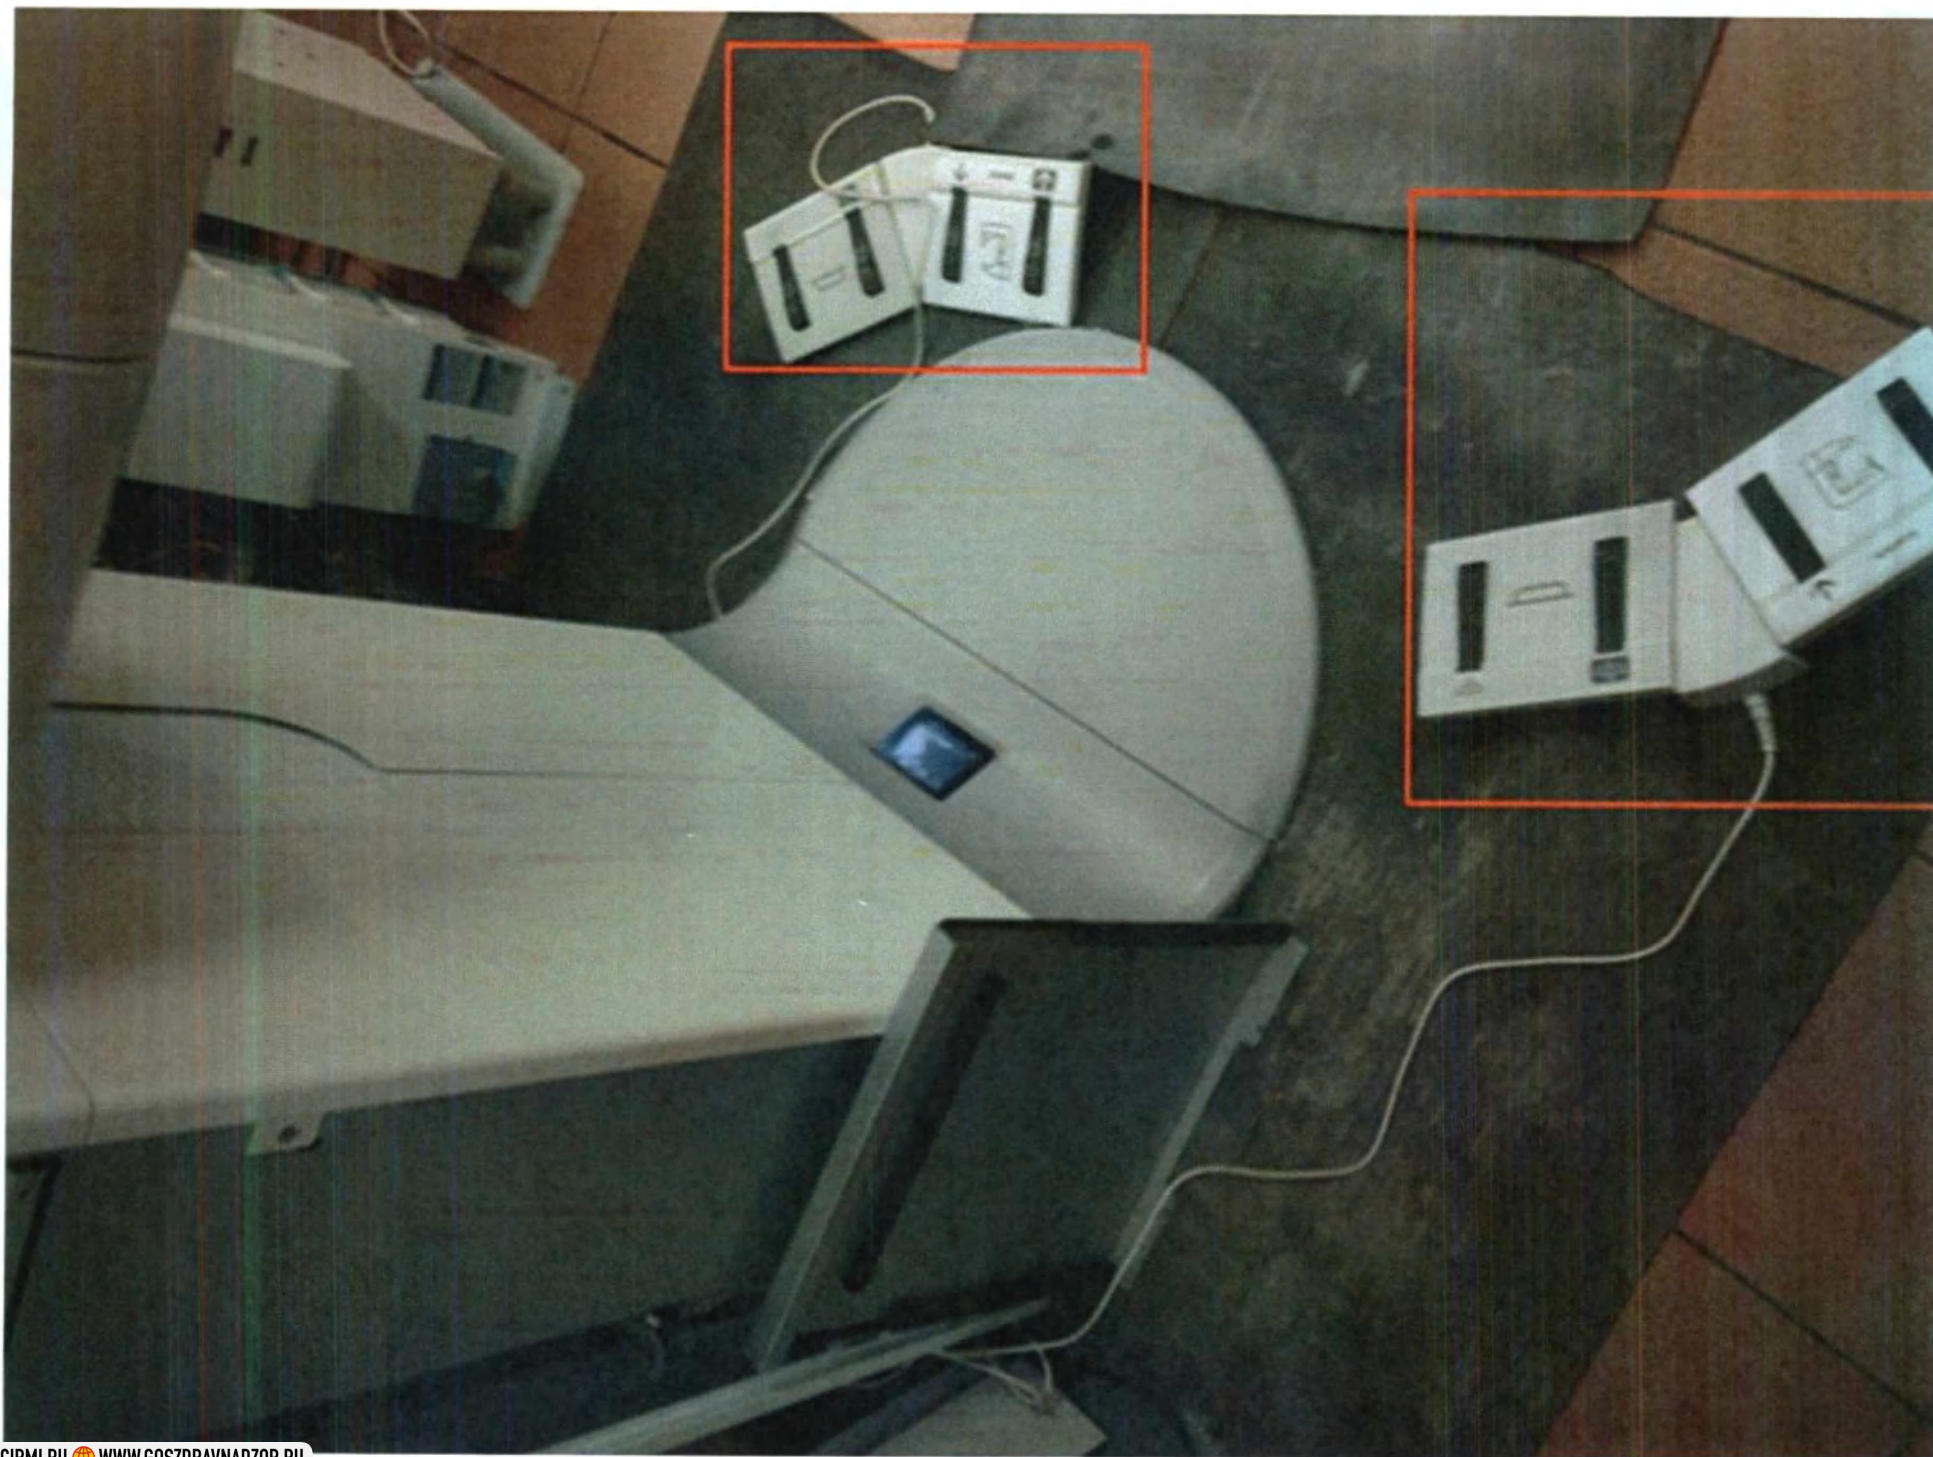

10. Пластина компрессионная 18х24 см с низким краем.



11. Пластина компрессионная 18x24 см с высоким краем.




12. Пластина компрессионная 24x30 см с низким краем.



13. Пластина компрессионная 24x30 см с высоким краем.



14. Пластина компрессионная 18x24 см для небольшой груди.

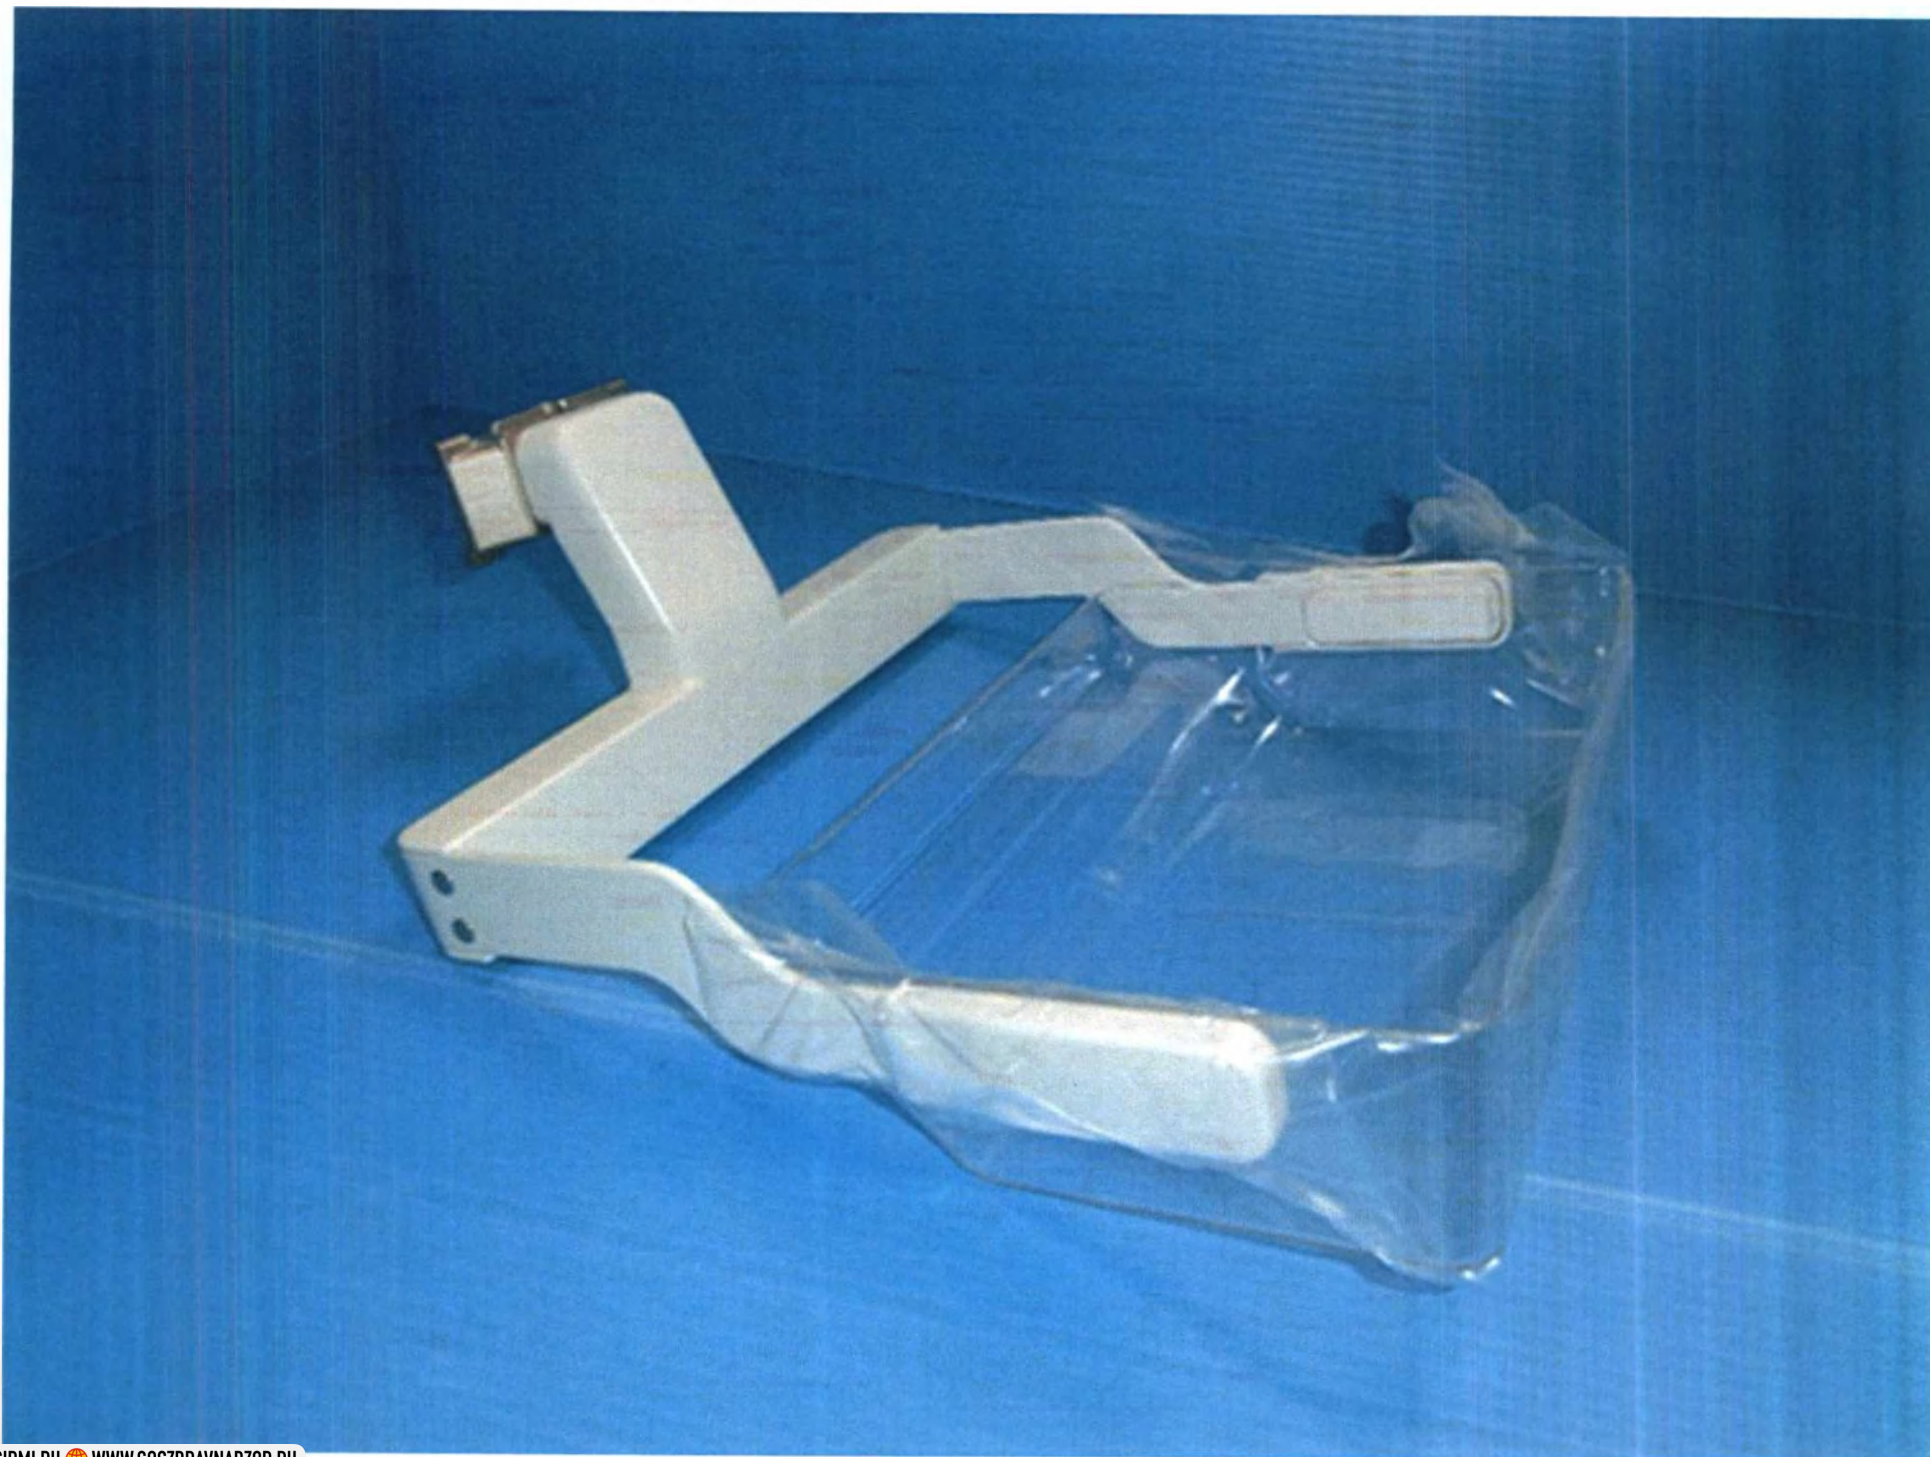


15. Пластина компрессионная 24х30 см для небольшой груди.



16. Пластина компрессионная 18х24 см с низким краем (флекс).



17. Пластина компрессионная 24х30 см с высоким краем (флекс).

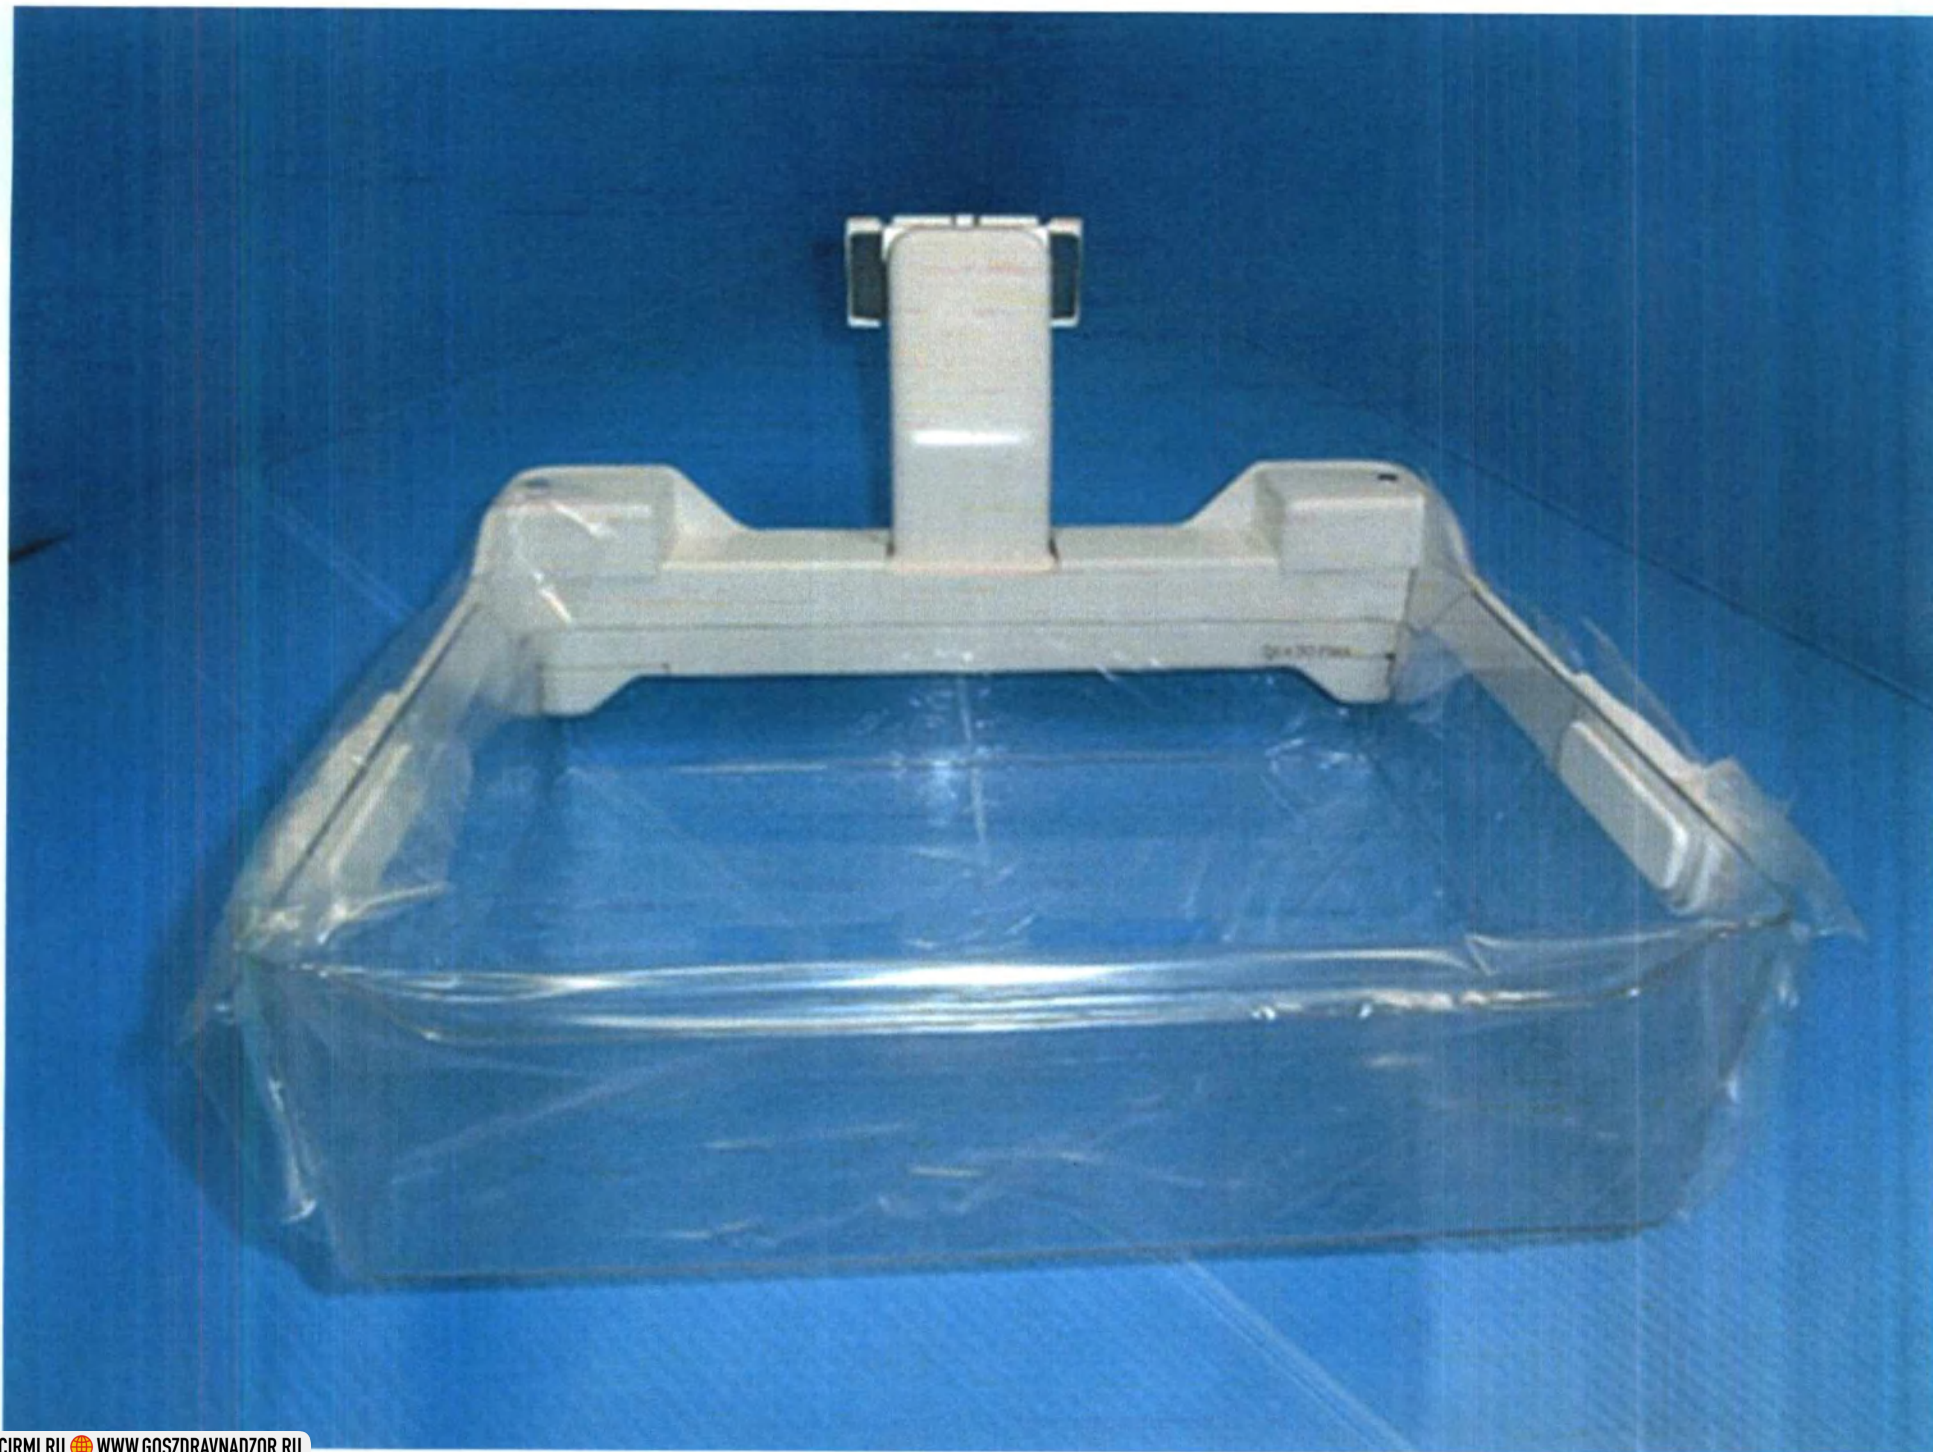

18. Пластина компрессионная повышенной гибкости 18x24 см с низким краем.



19. Пластина компрессионная повышенной гибкости 24х30 см с высоким краем.



20. Пластина компрессионная для латеральной биопсии.




21. Пластина компрессионная для вертикальной биопсии.



22. Пластина компрессионная квадратная для прицельной съемки.



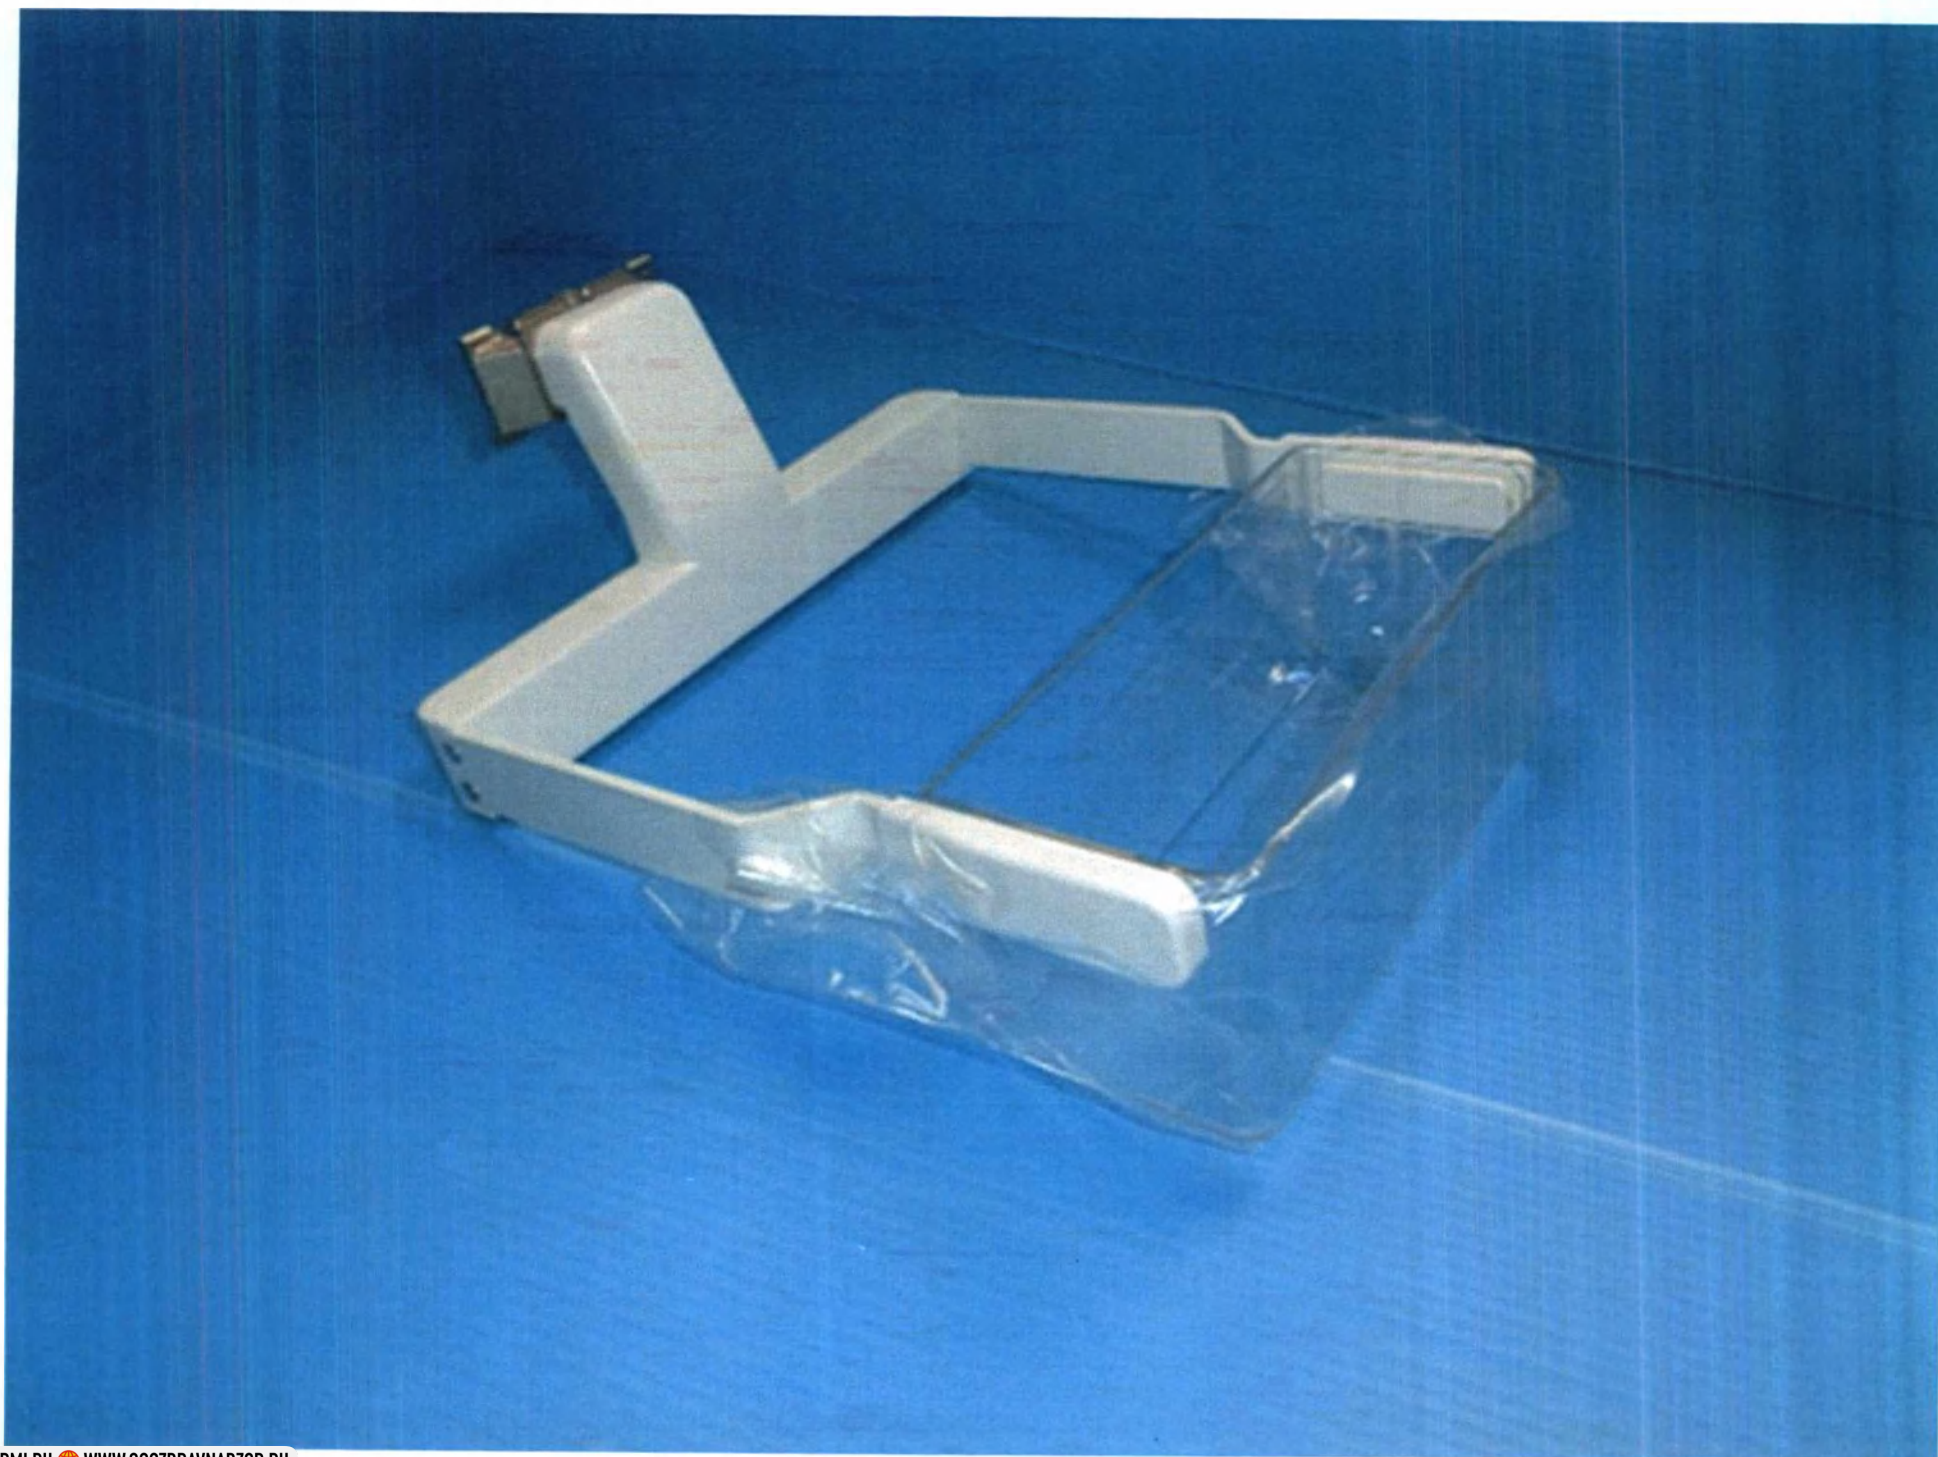


24. Пластина компрессионная для съемки с увеличением.




25. Пластина компрессионная квадратная для прицельной съемки с увеличением.




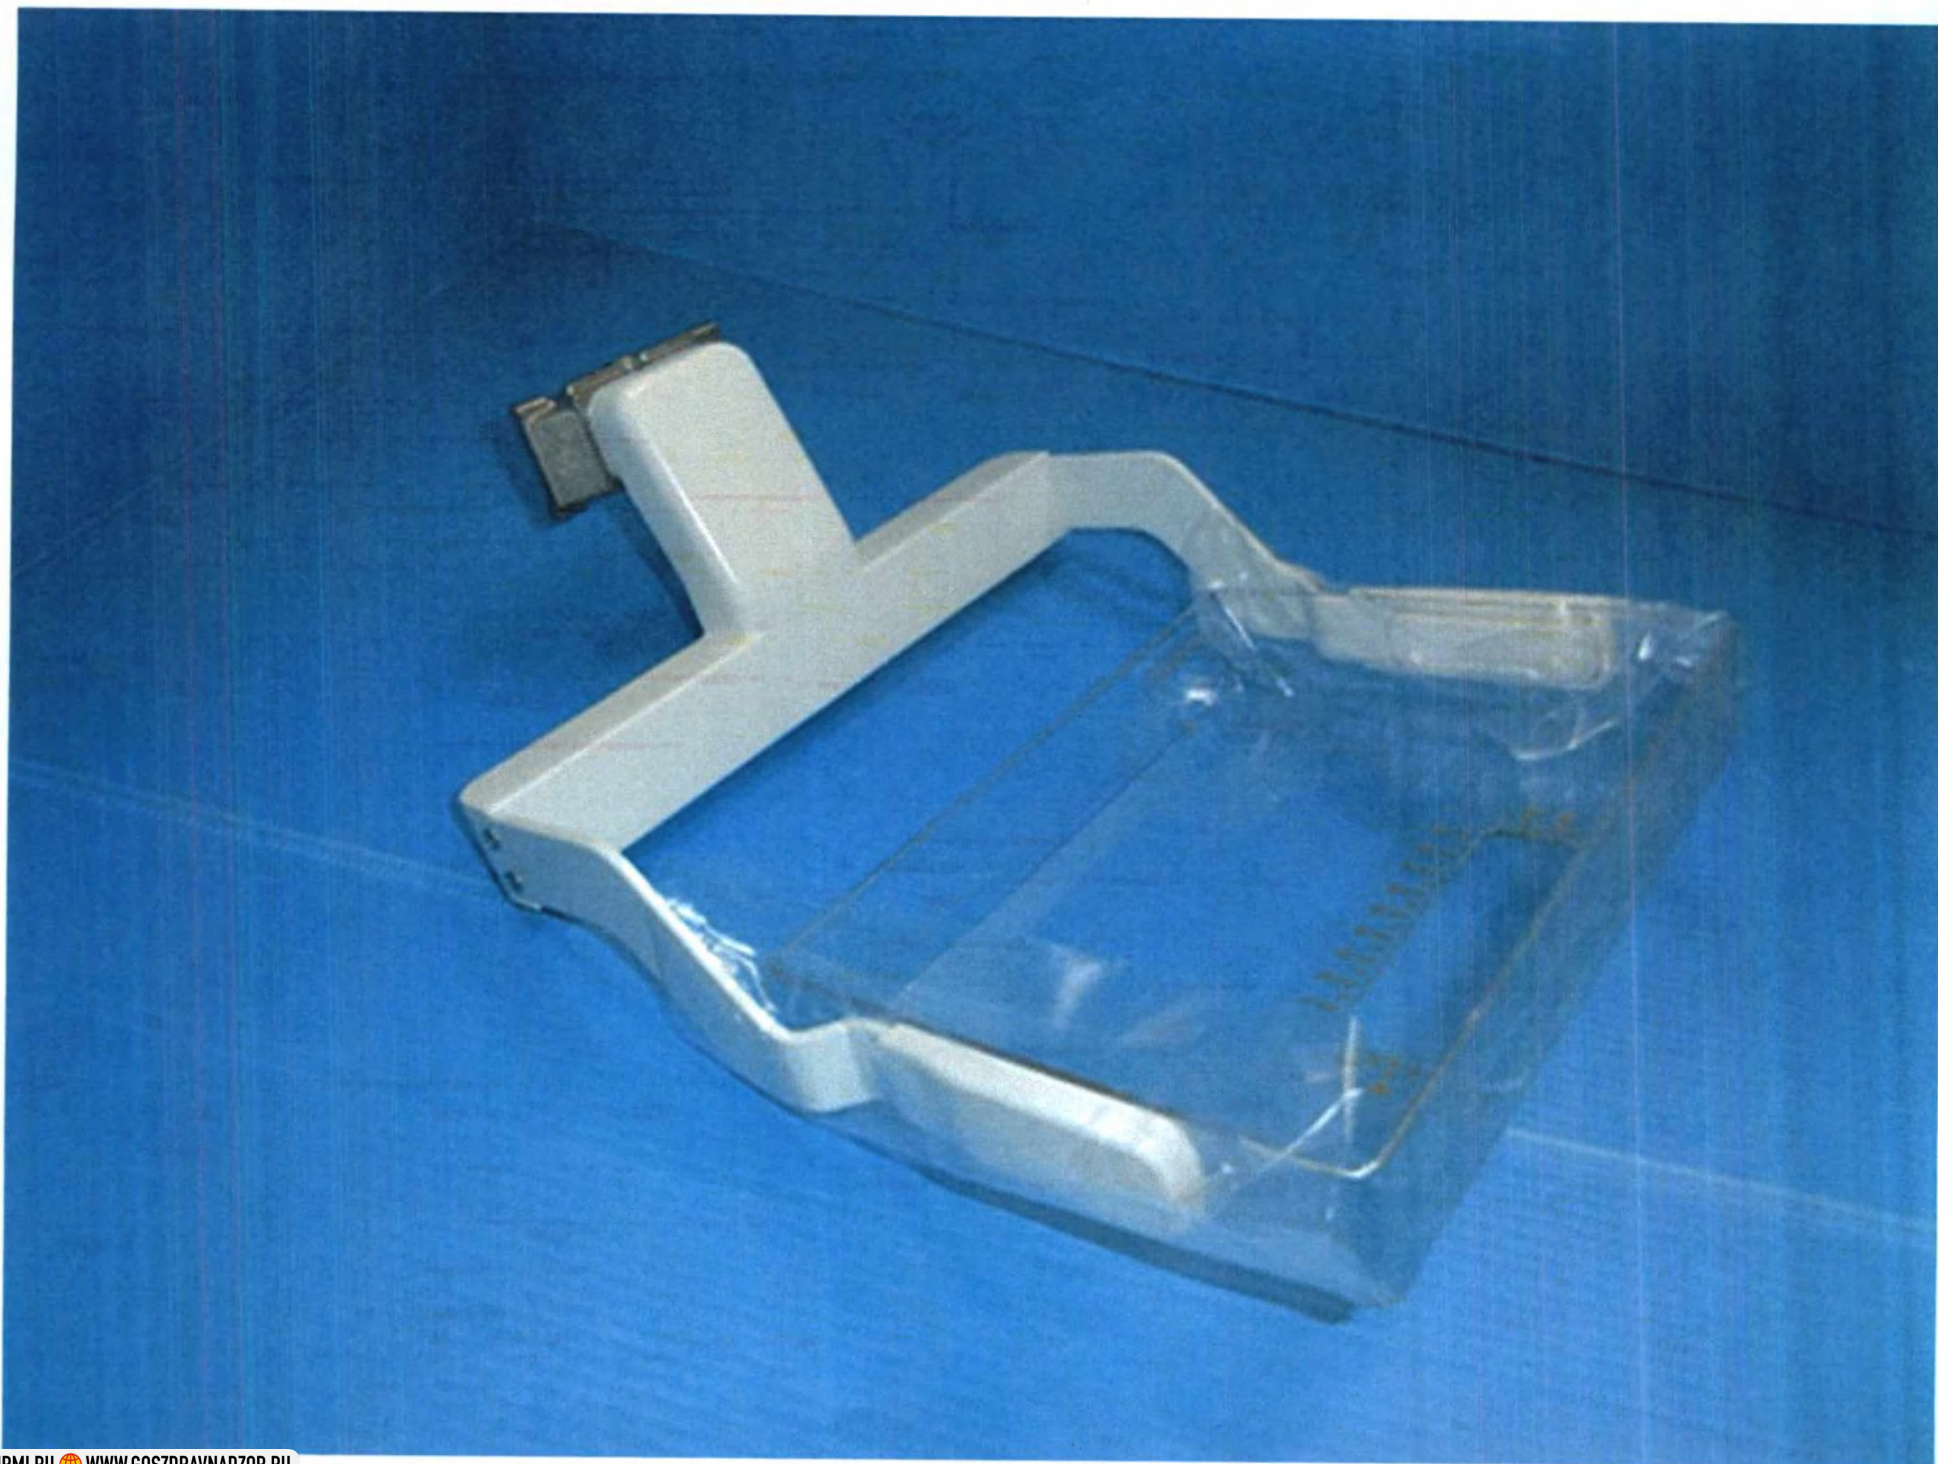

27. Пластина компрессионная круглая для прицельной съемки.

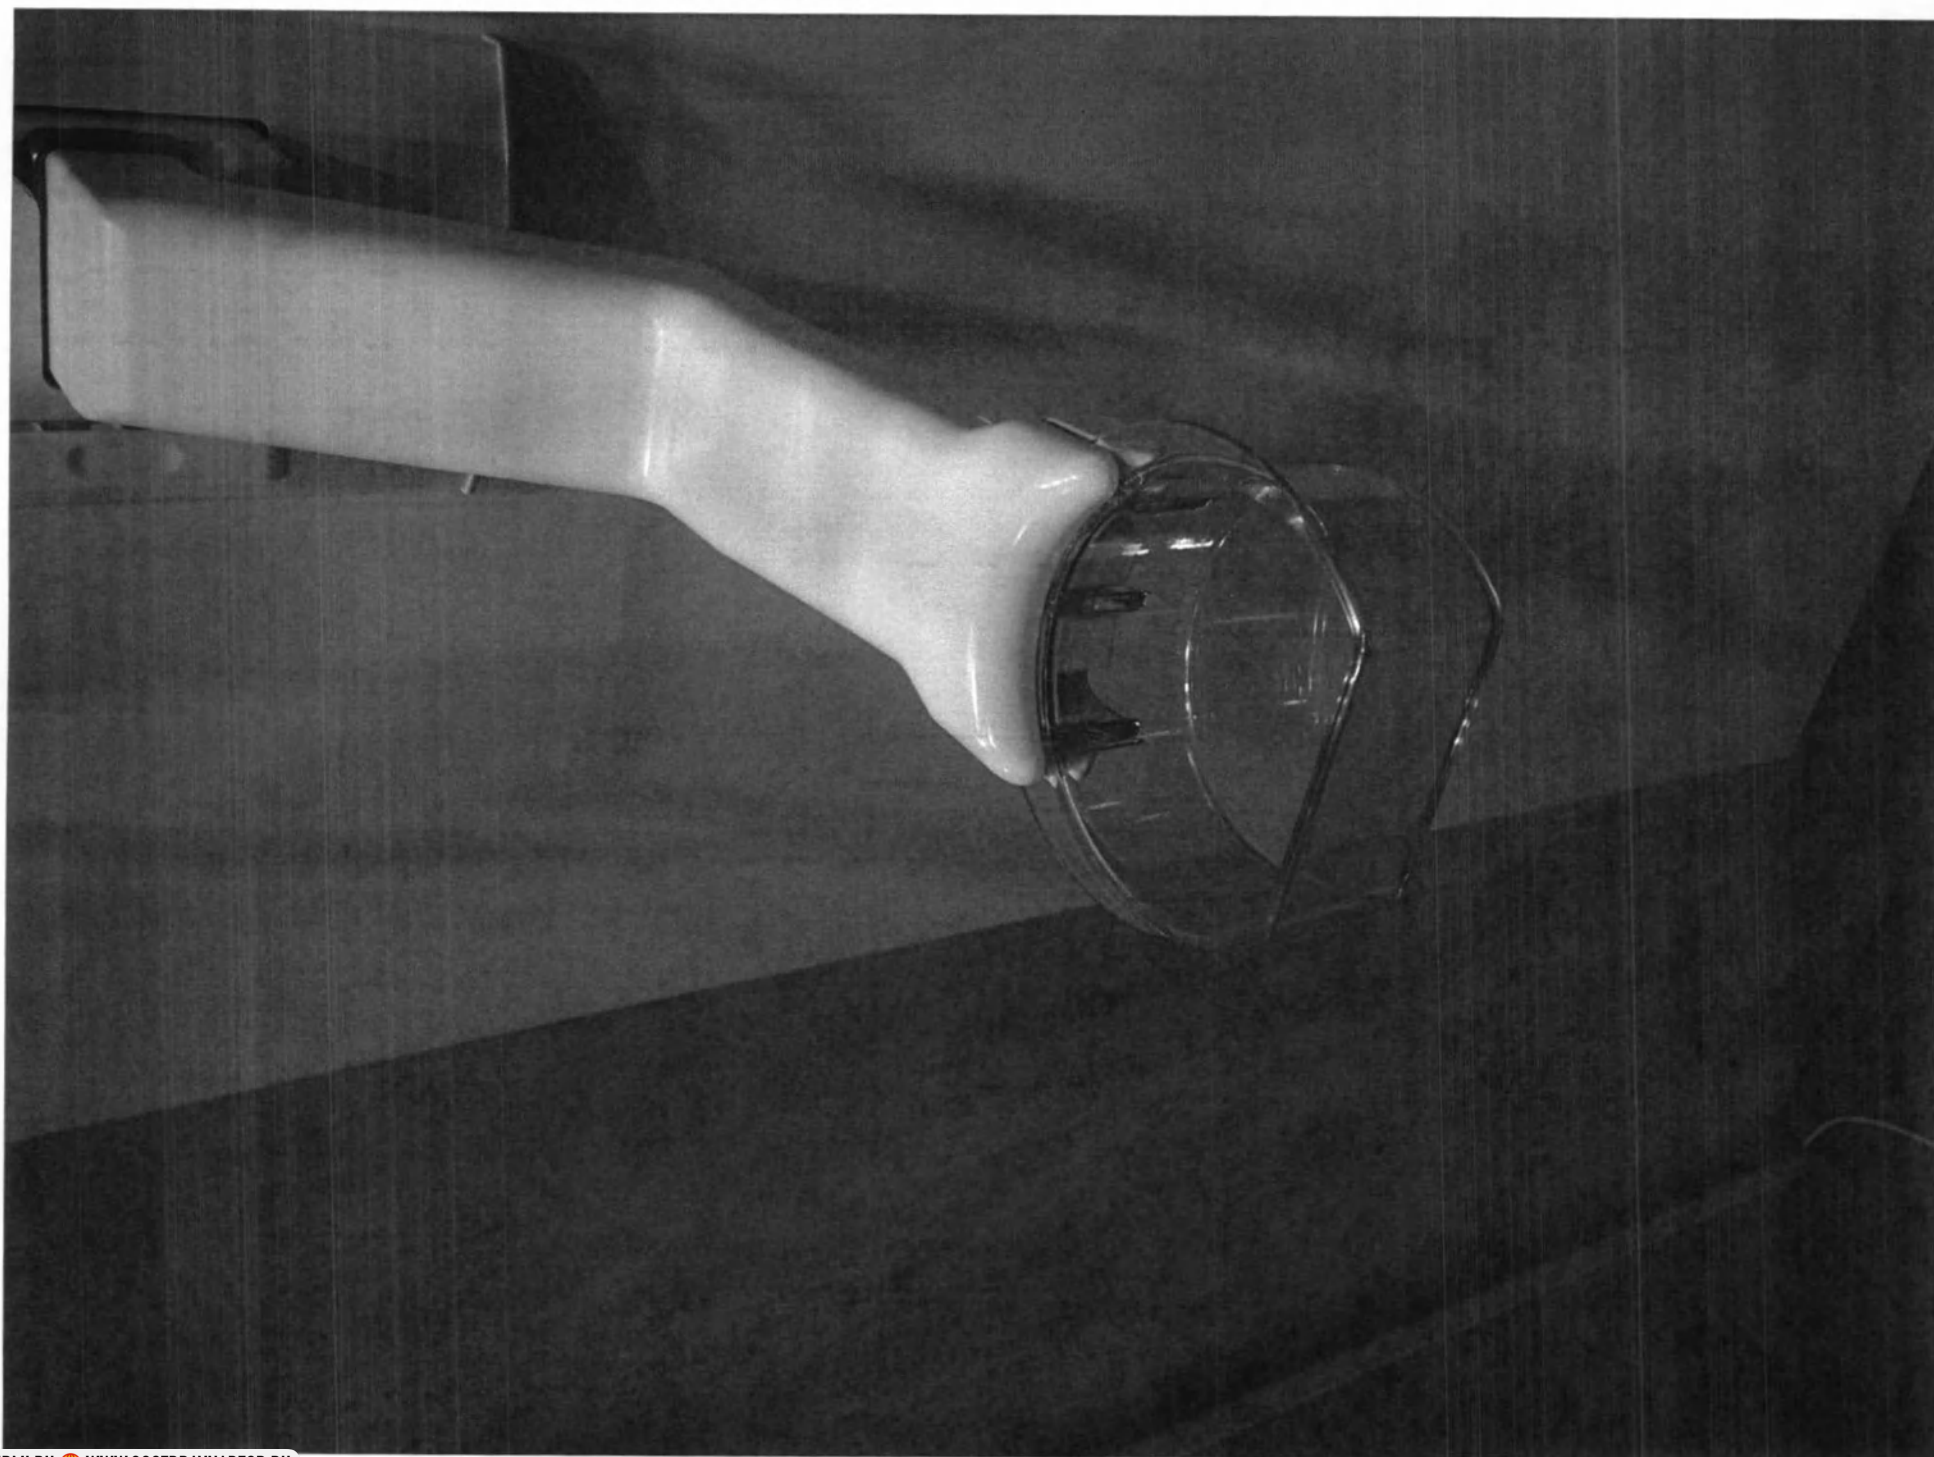

28. Пластина компрессионная круглая для прицельной съемки с увеличением.

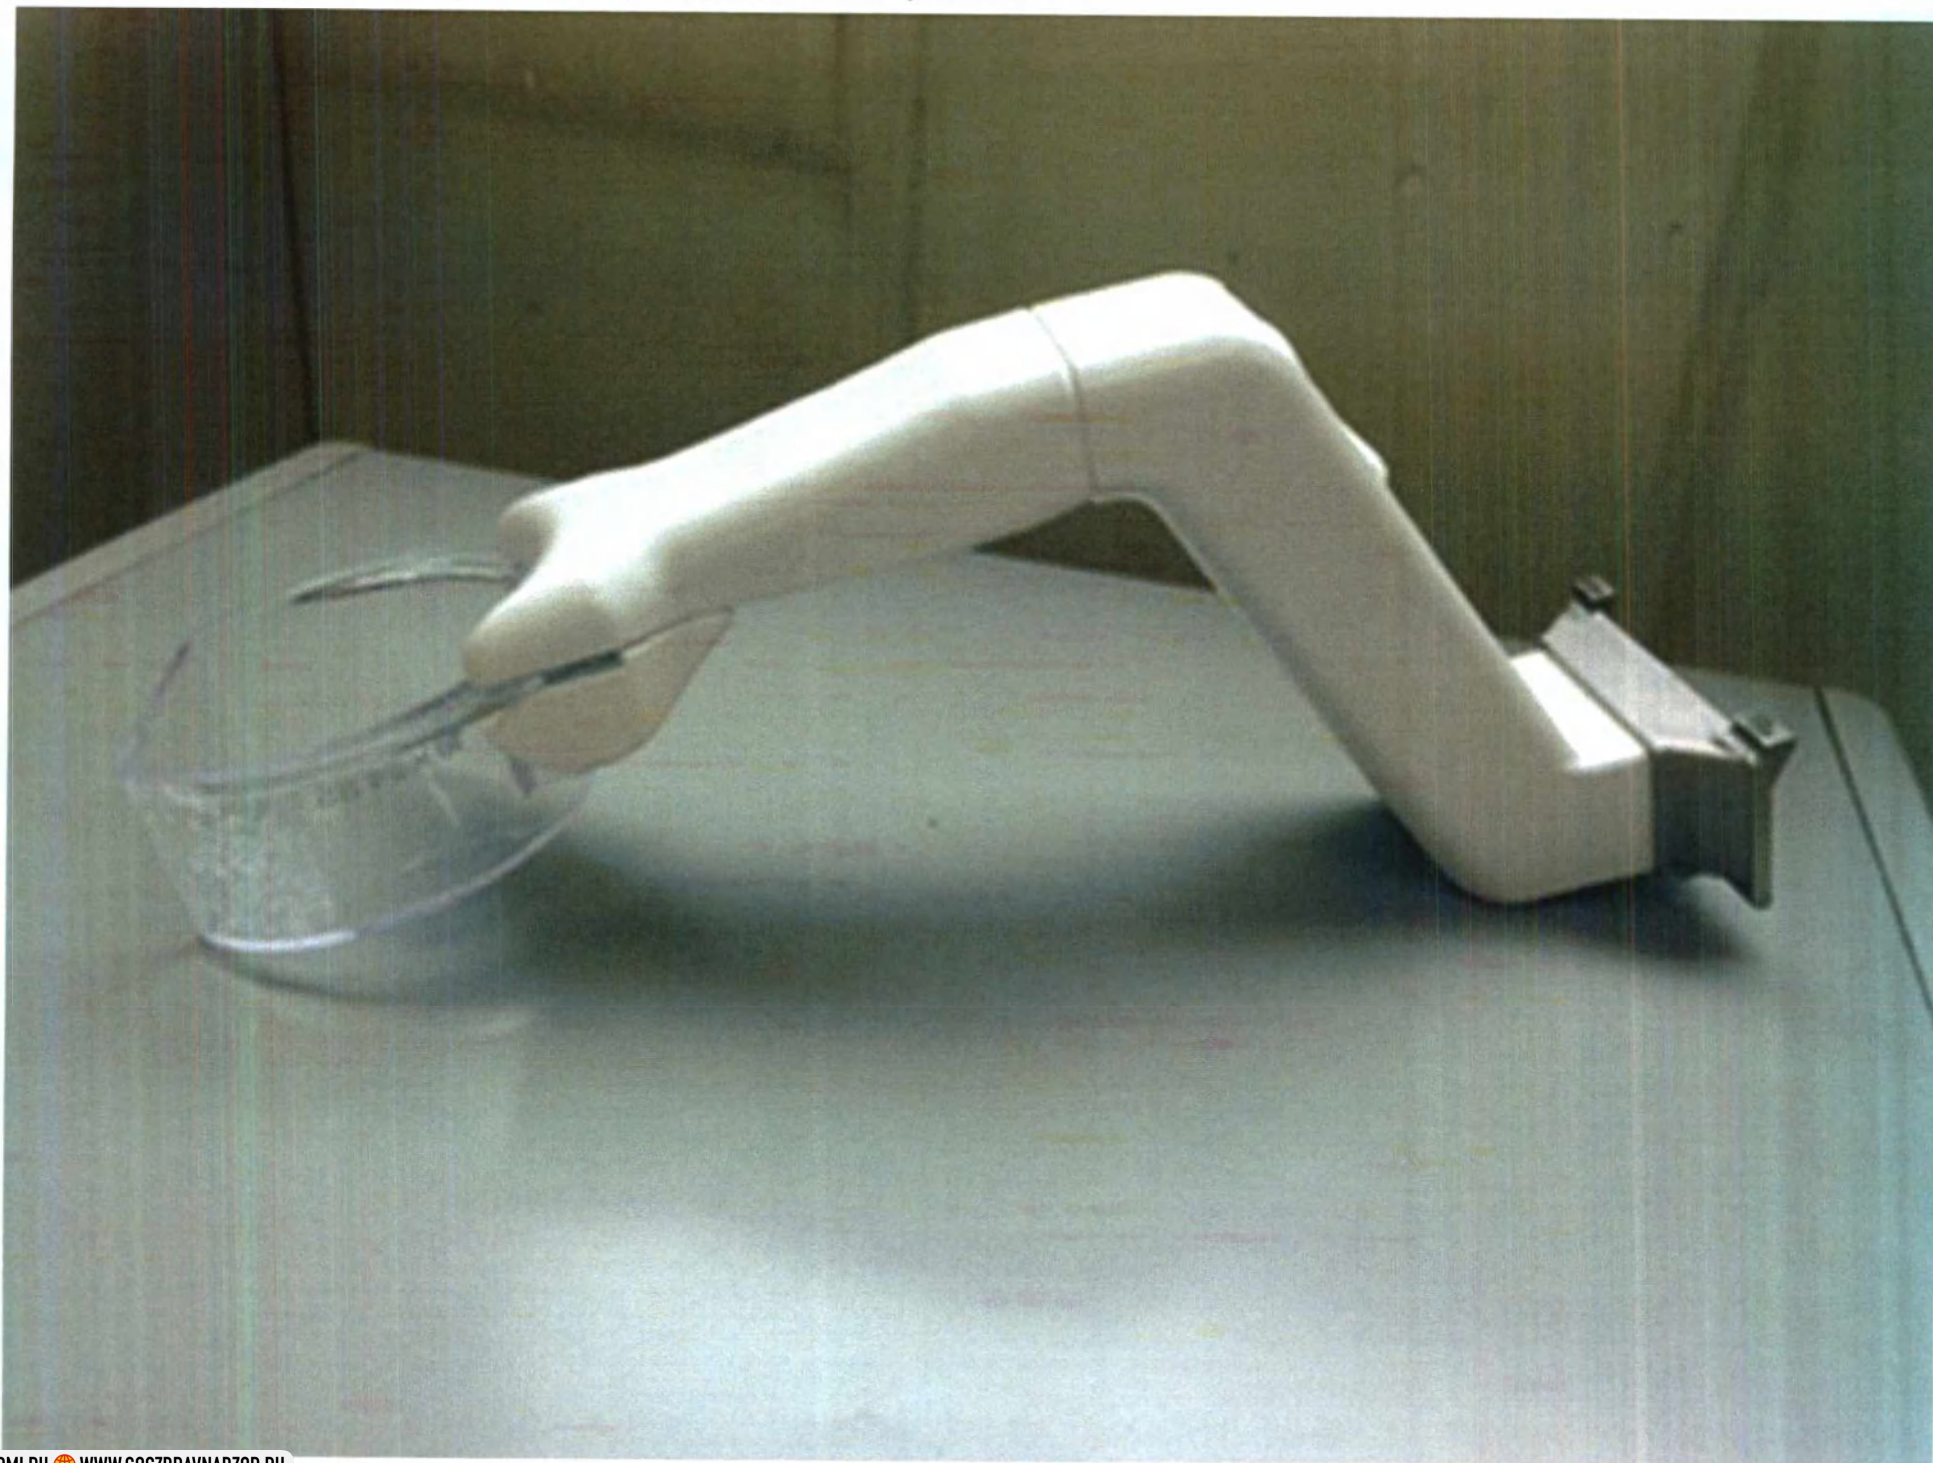

29. Отсеки настенные для хранения пластин компрессионных - не более 12 шт.






31. Пульт дистанционный ручной для управления экспозицией.




32. Пульт дистанционный ножной для управления экспозицией.

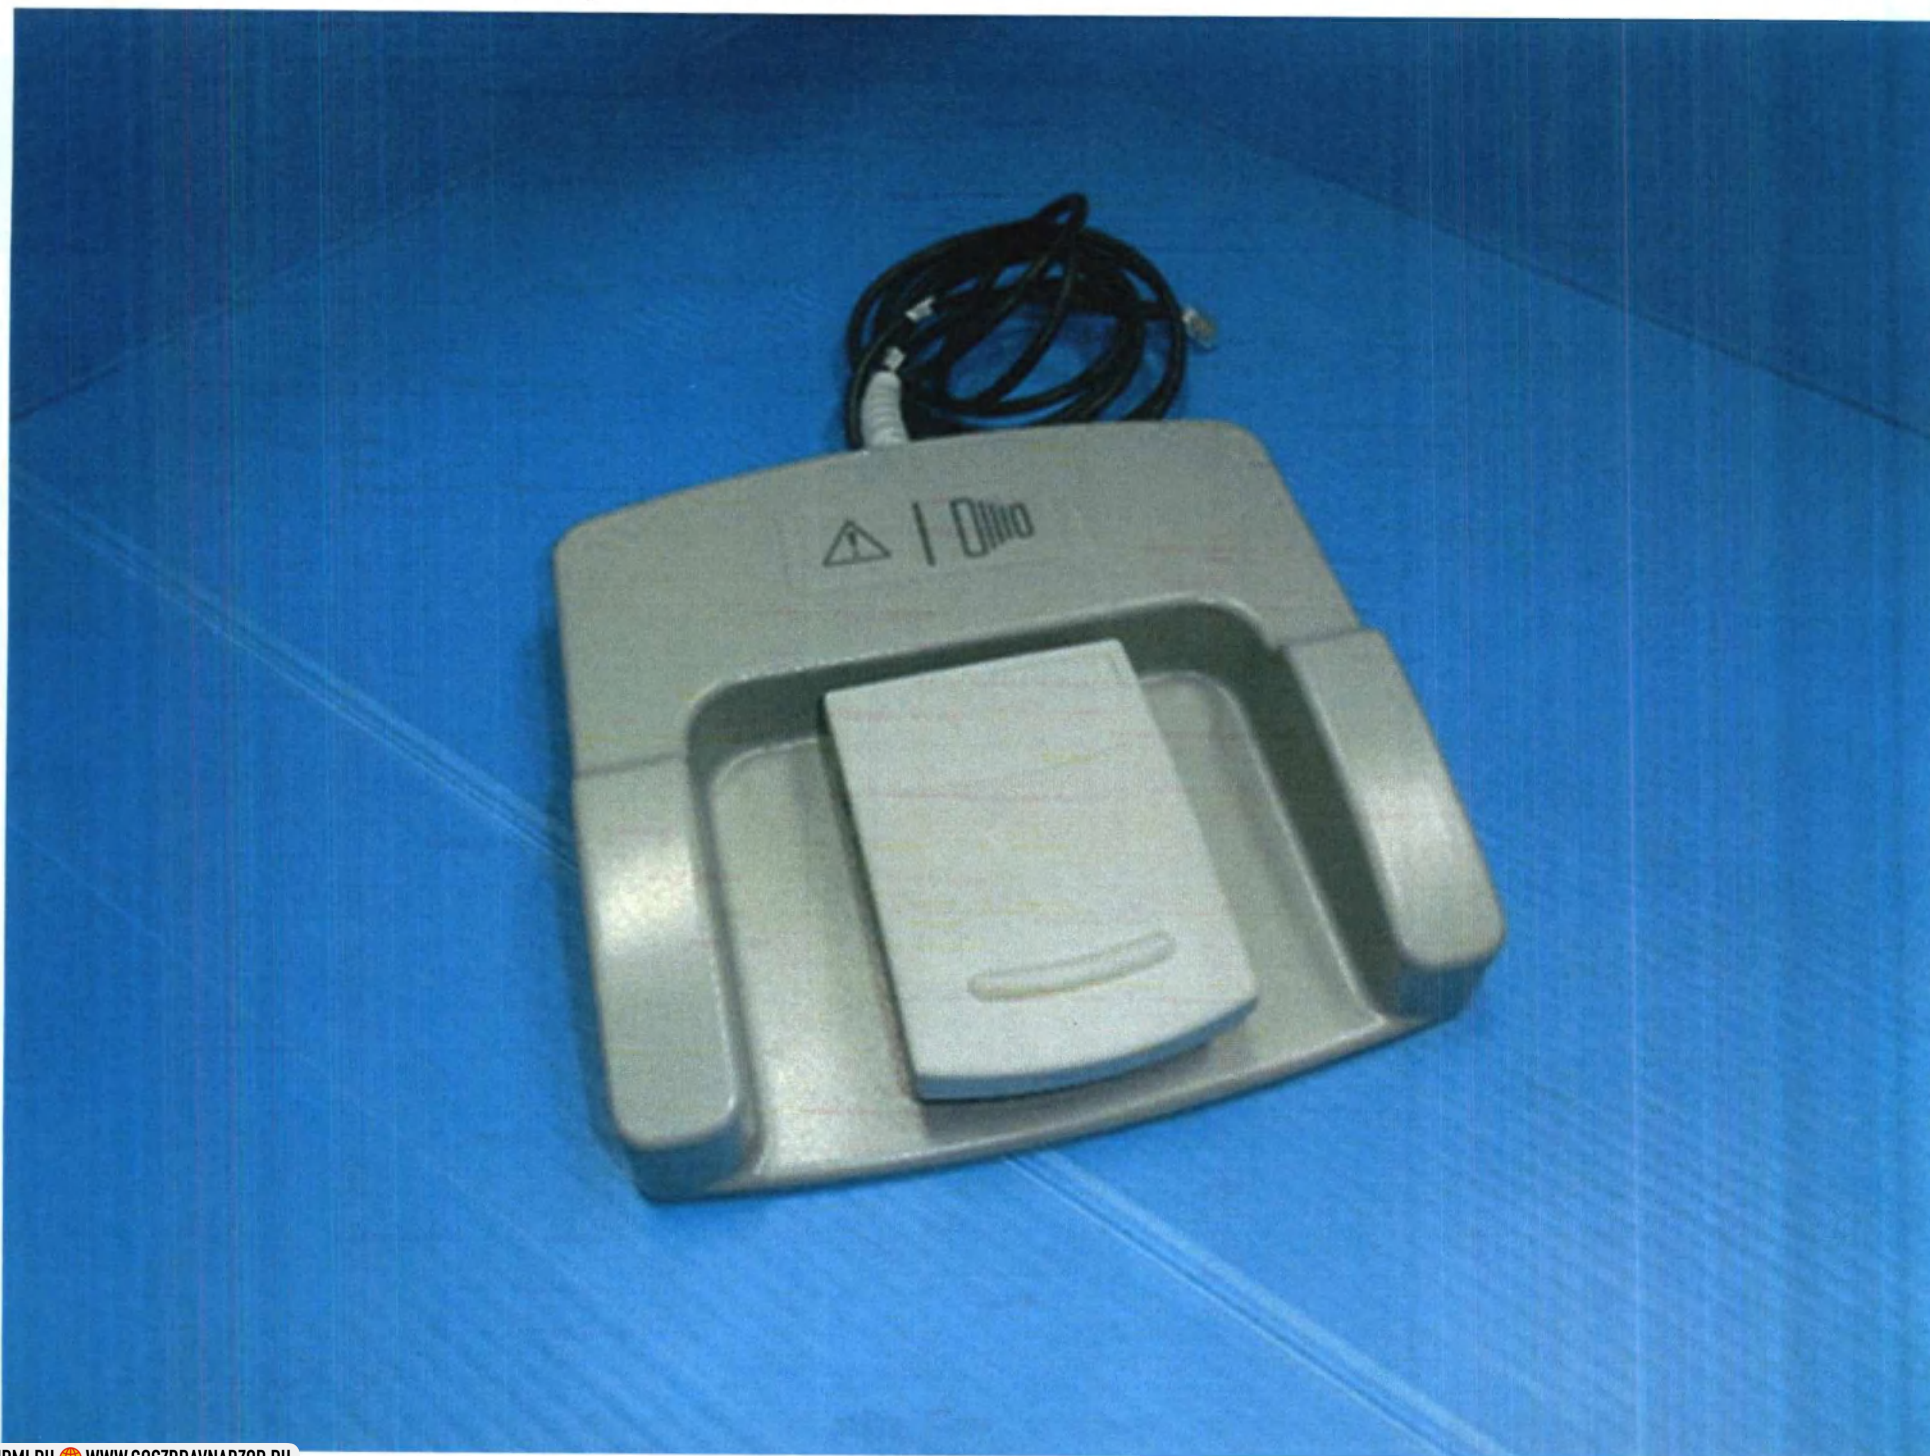


33. Подкладки подмышечные (левая) - не более 15 шт.



34. Подкладки подмышечные (правая) - не более 15 шт.

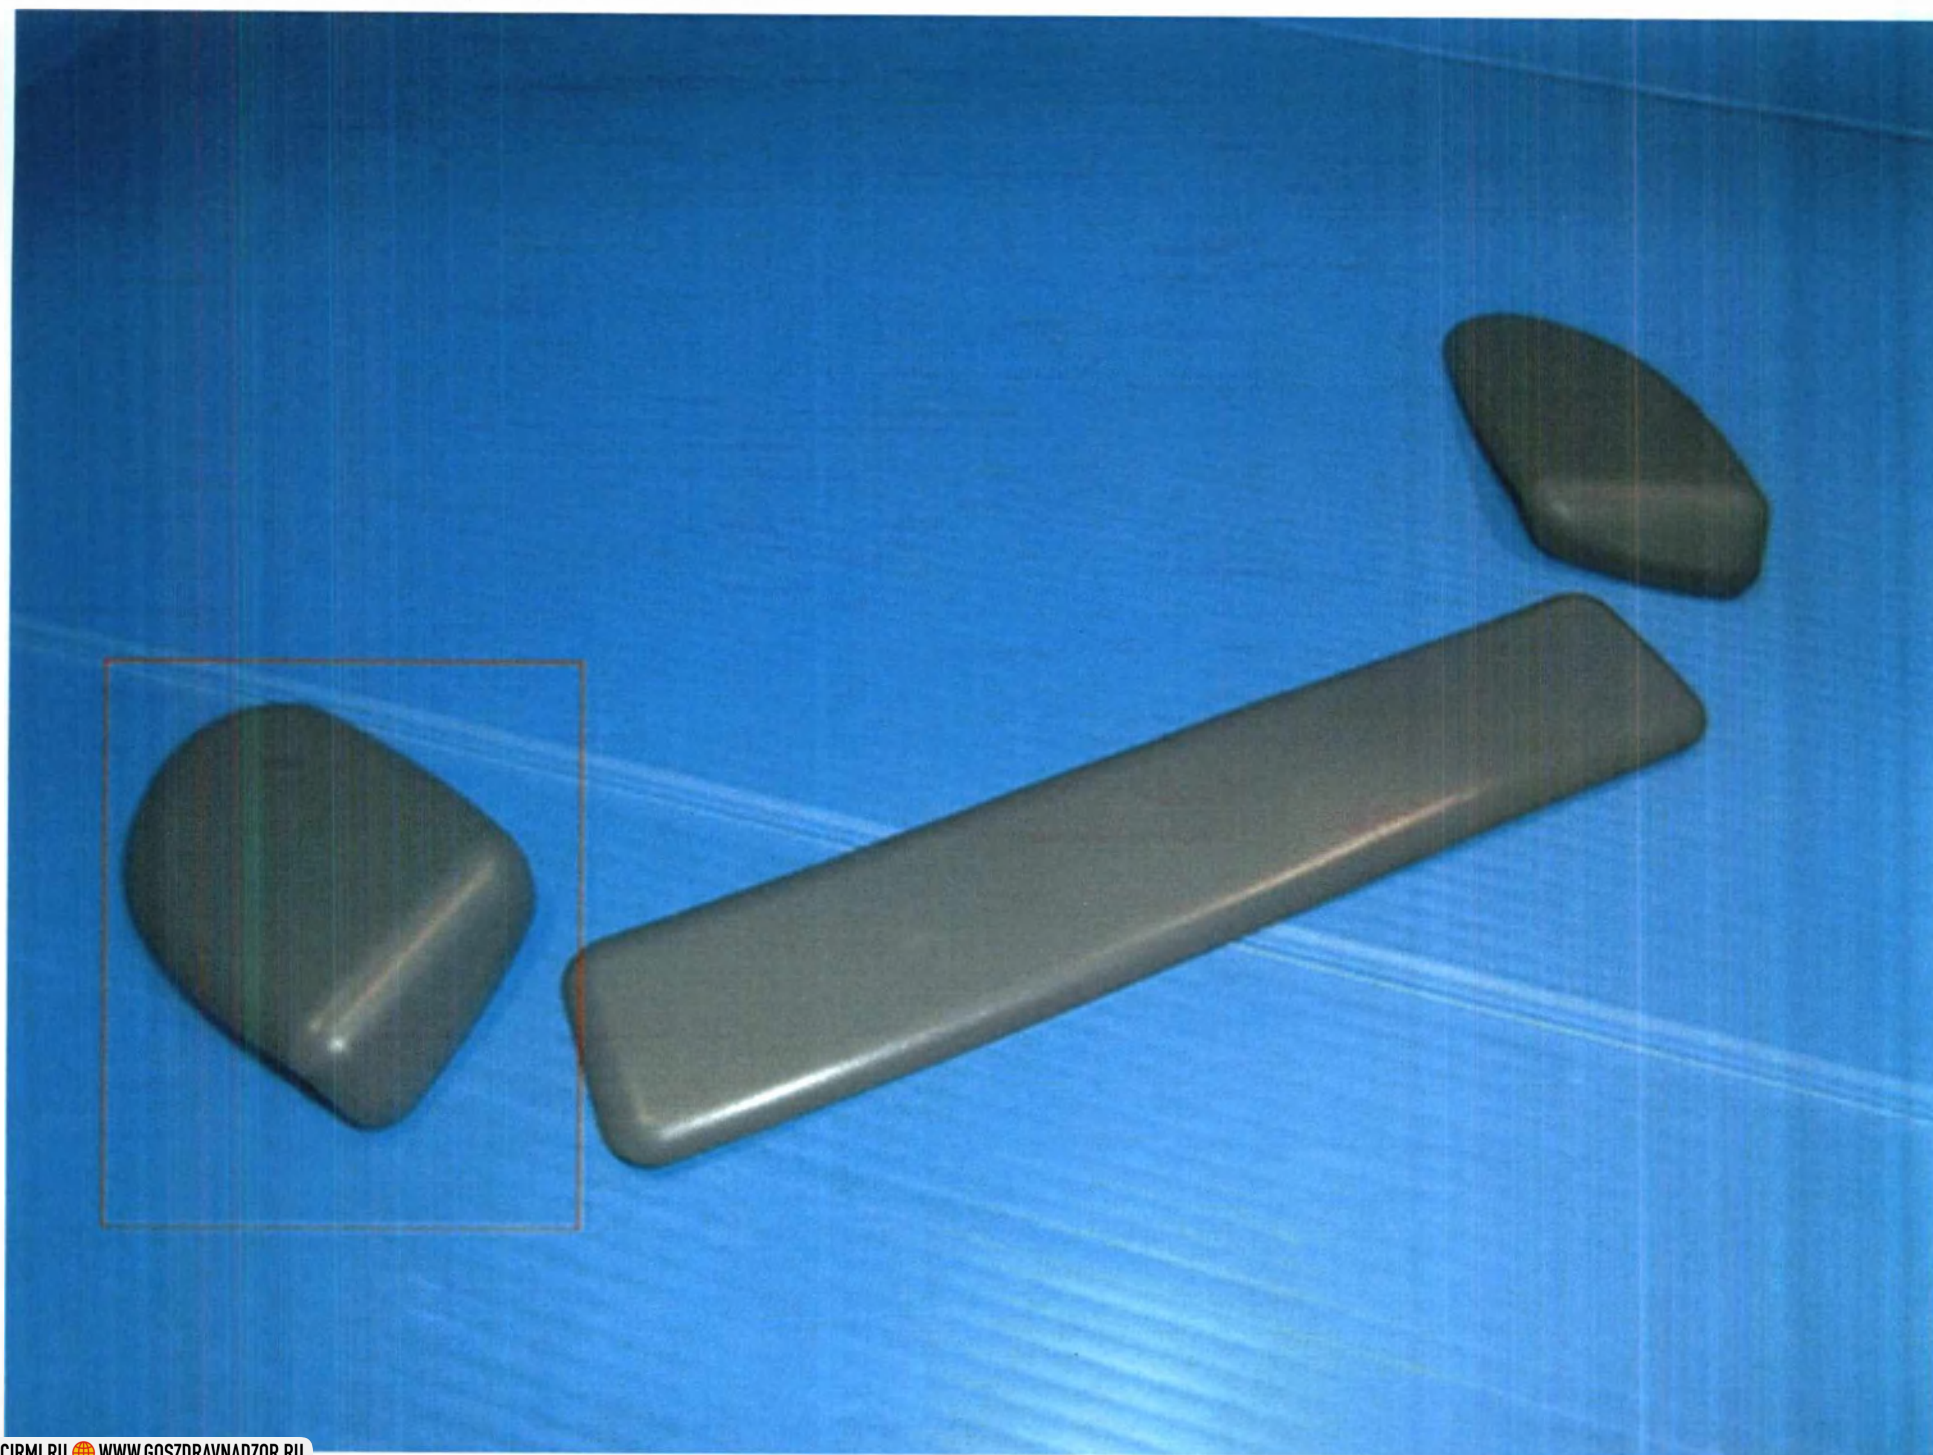


35. Подкладки для грудной стенки - не более 15 шт.

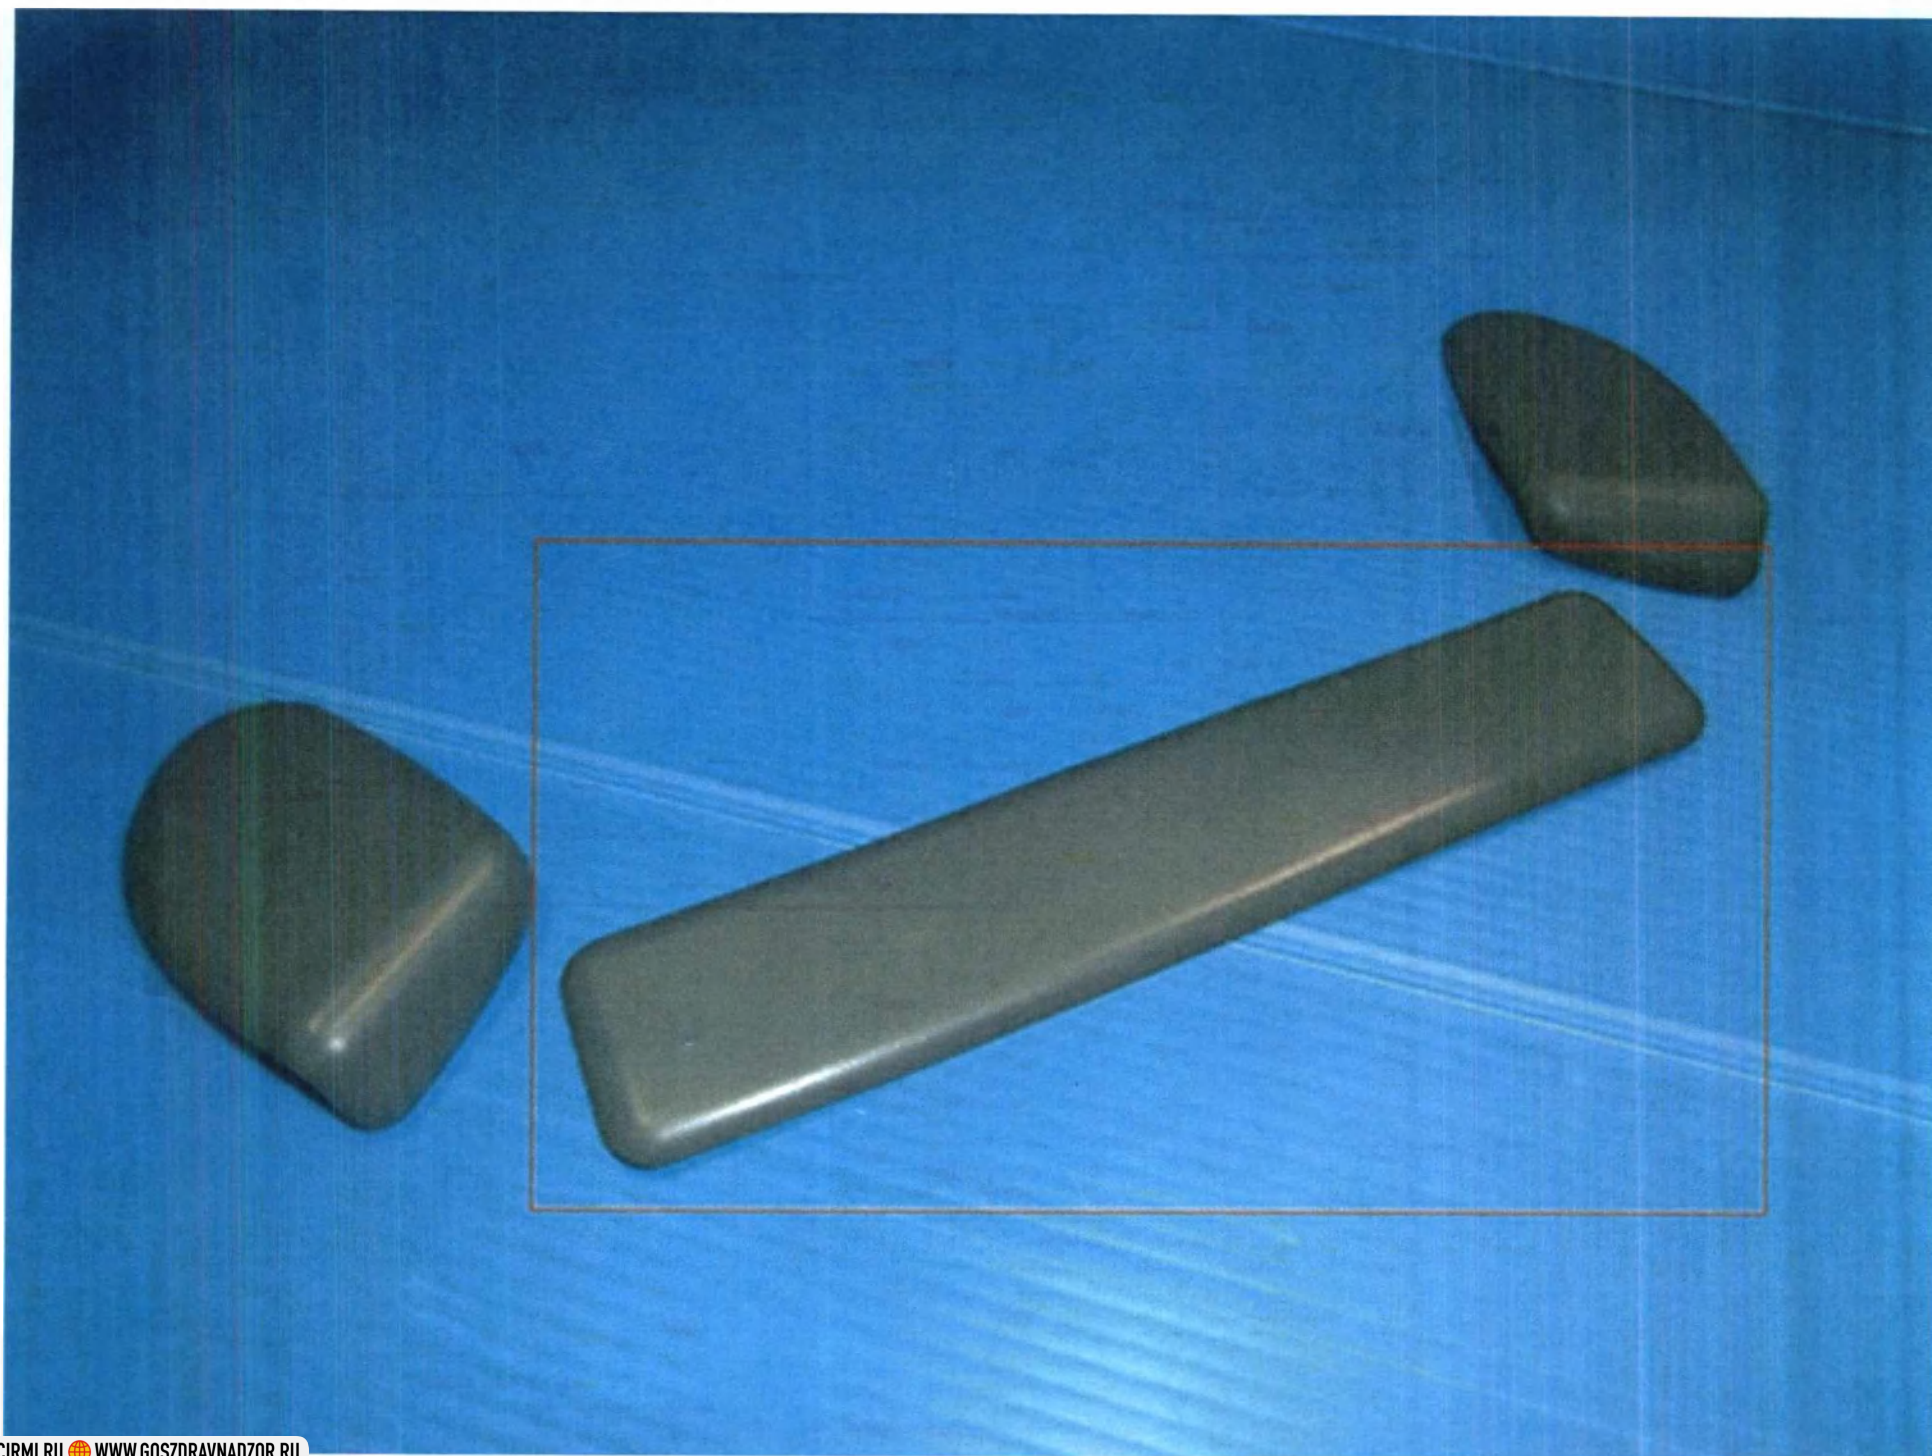



37. Рентгенозащитное стекло для стойки оператора.



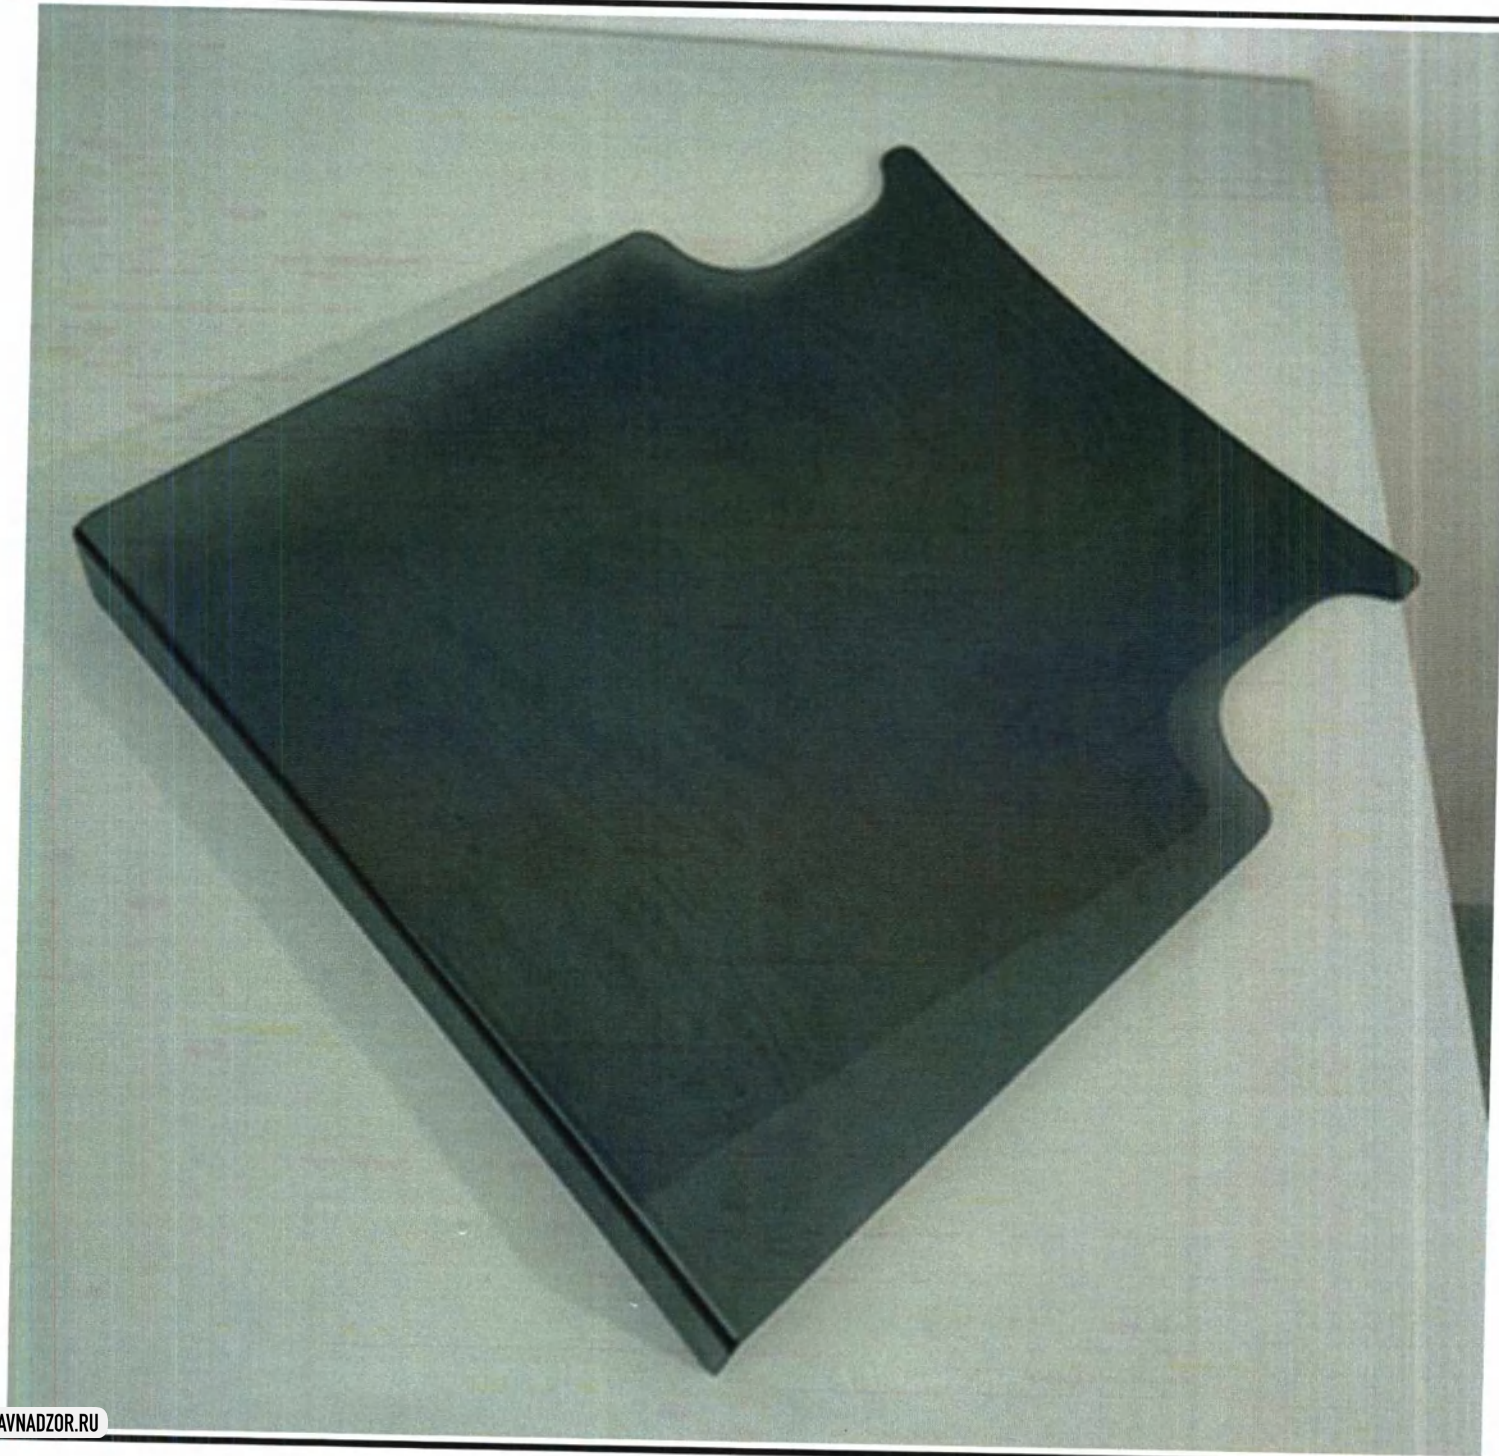

39. Плита монтажная для стойки оператора.




40. Удлинение для защитного экрана для стойки оператора.




41. Стойка с отсеками для хранения принадлежностей.



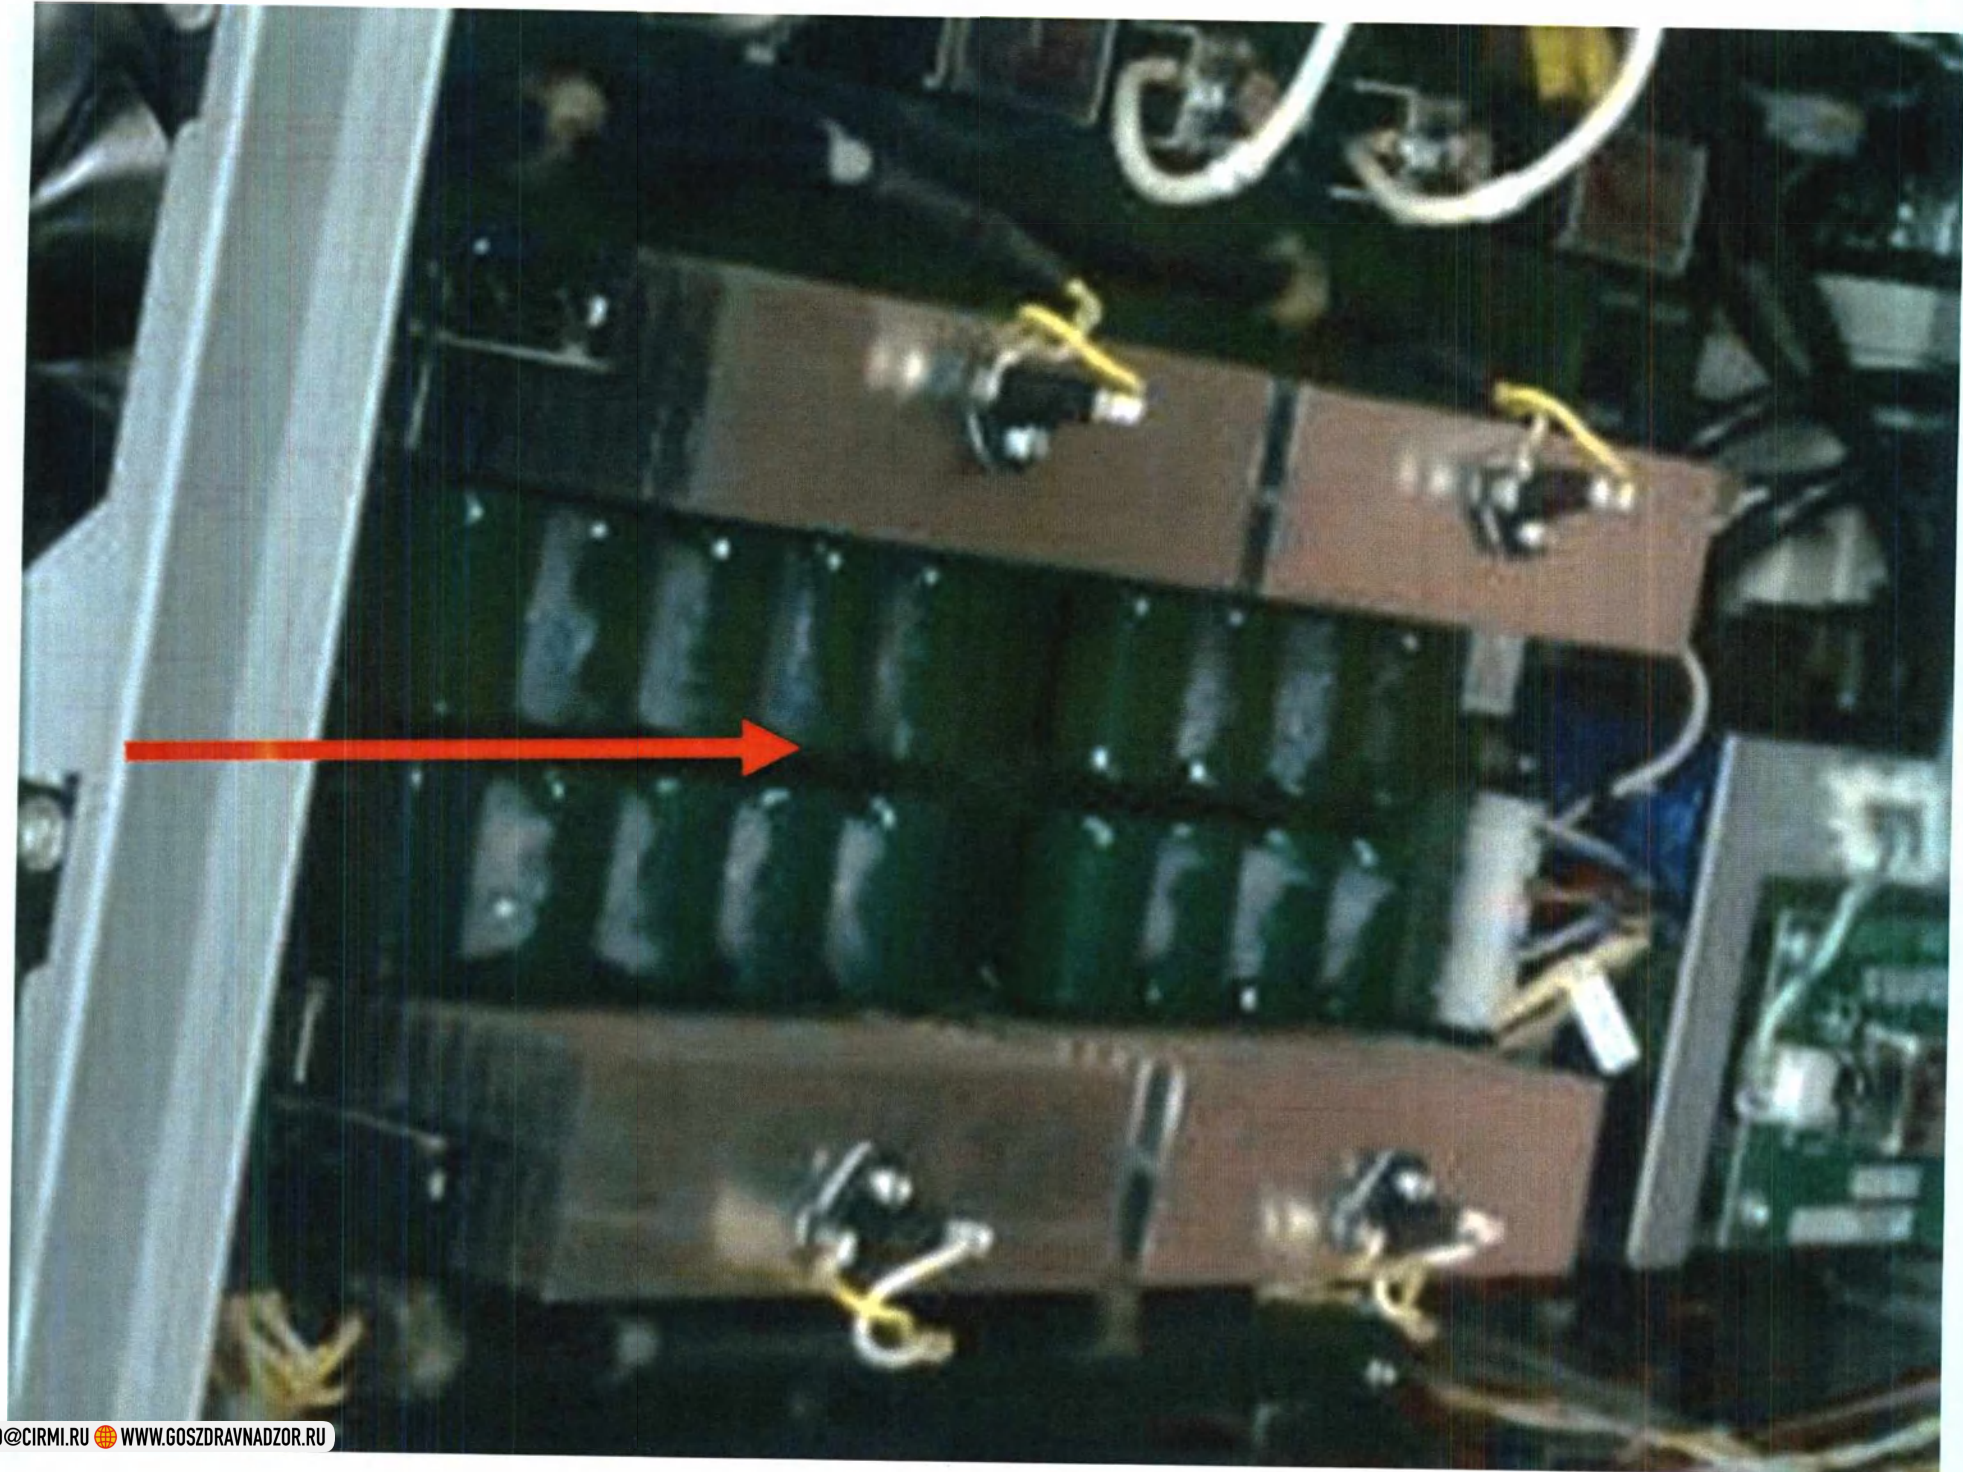


43. Экран для защиты лица при томосинтезе, подвижный.

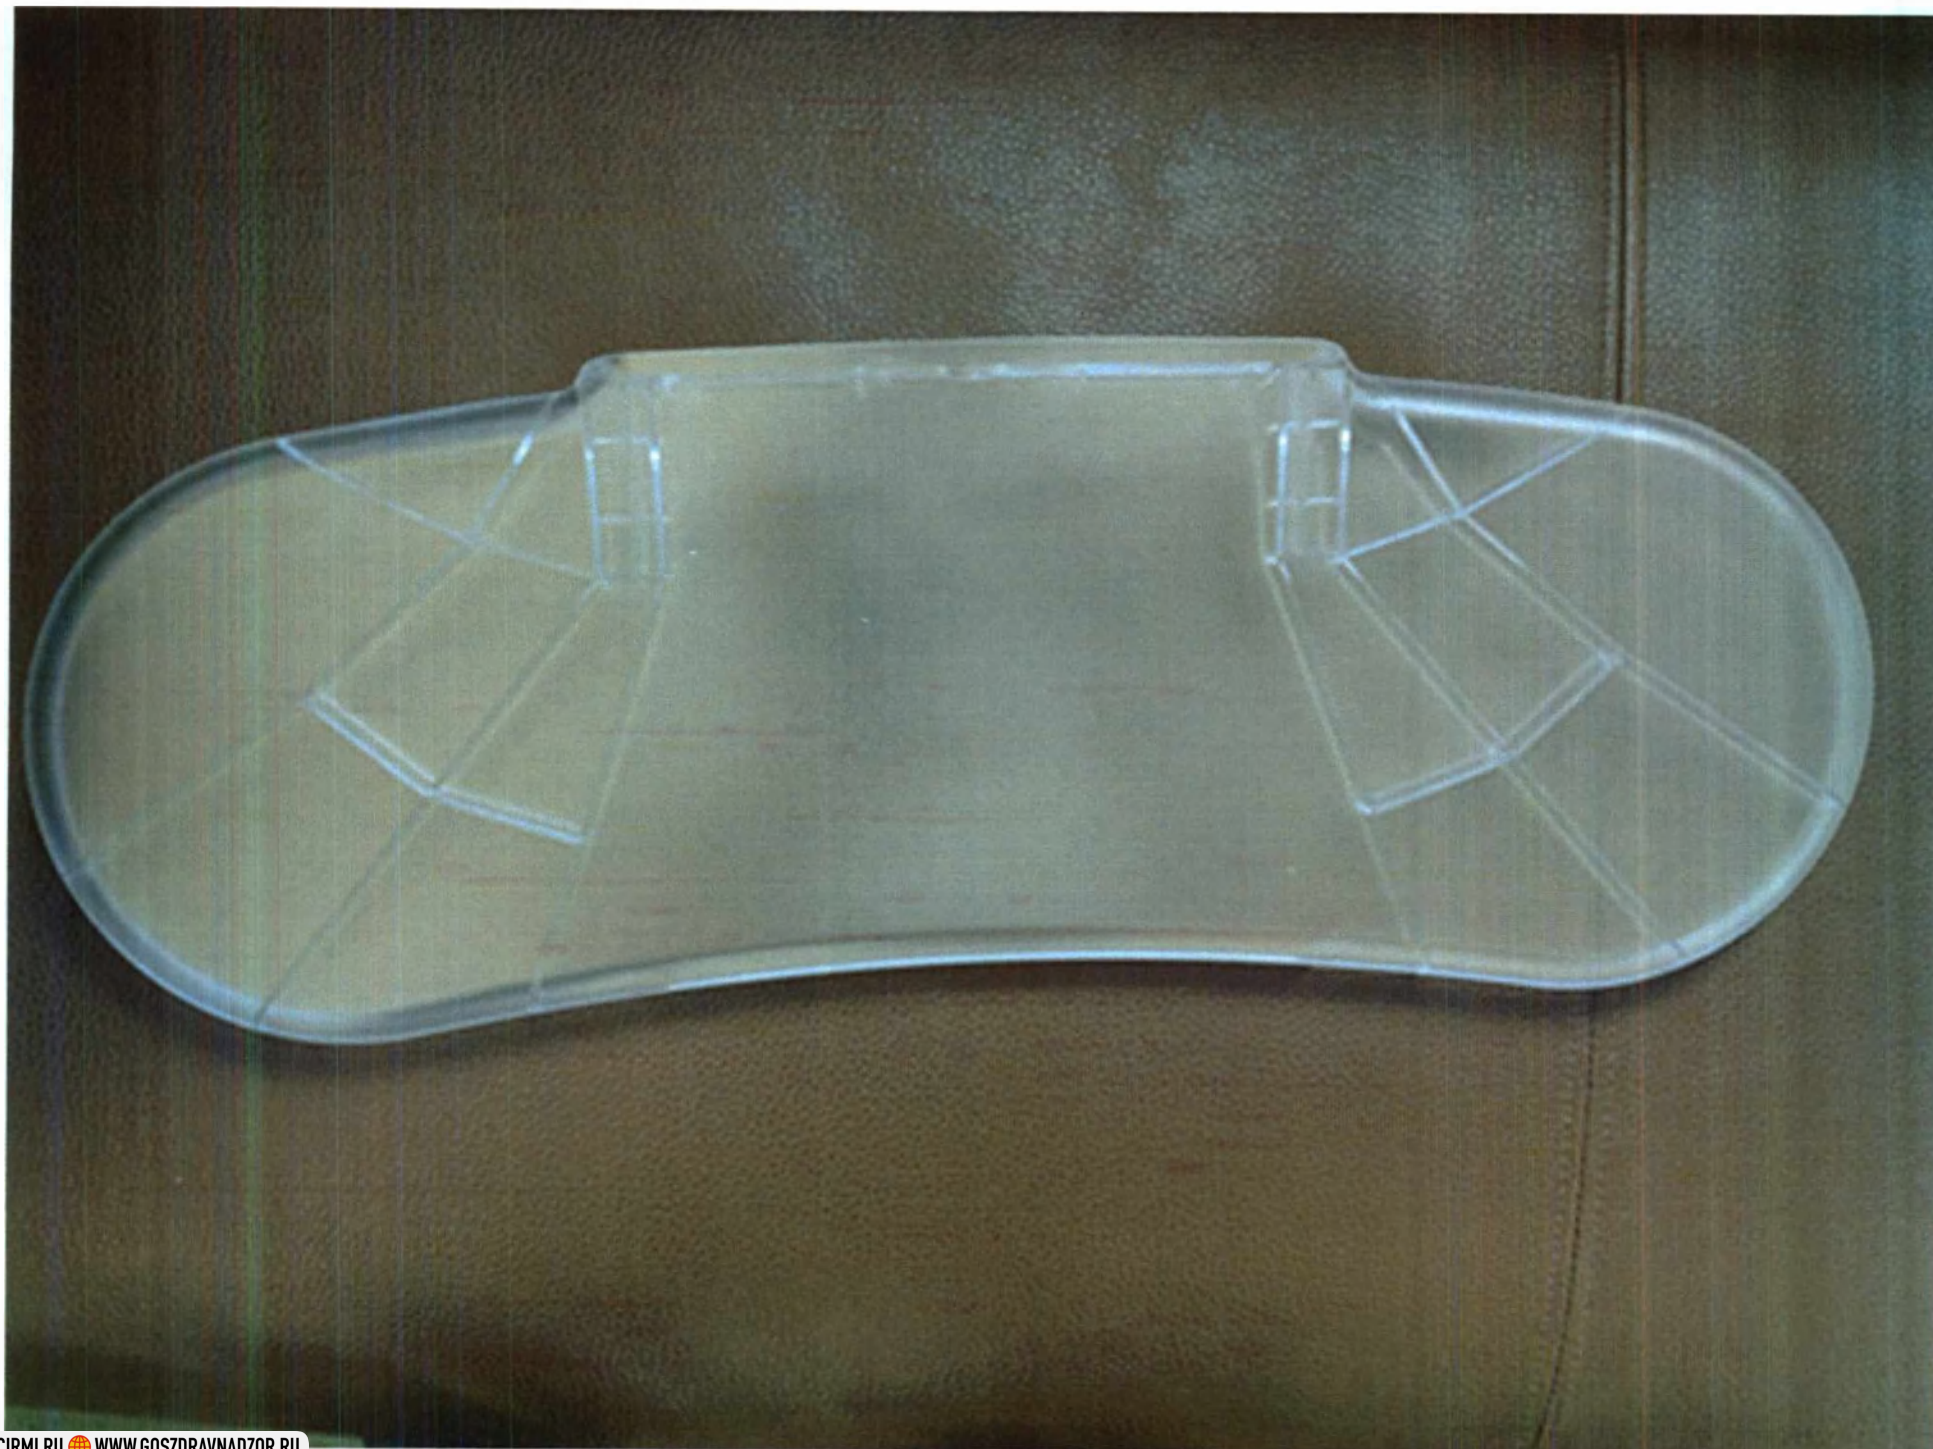



44. Экран для защиты лица при томосинтезе, неподвижный.




45. Нижняя перекладина для рук.

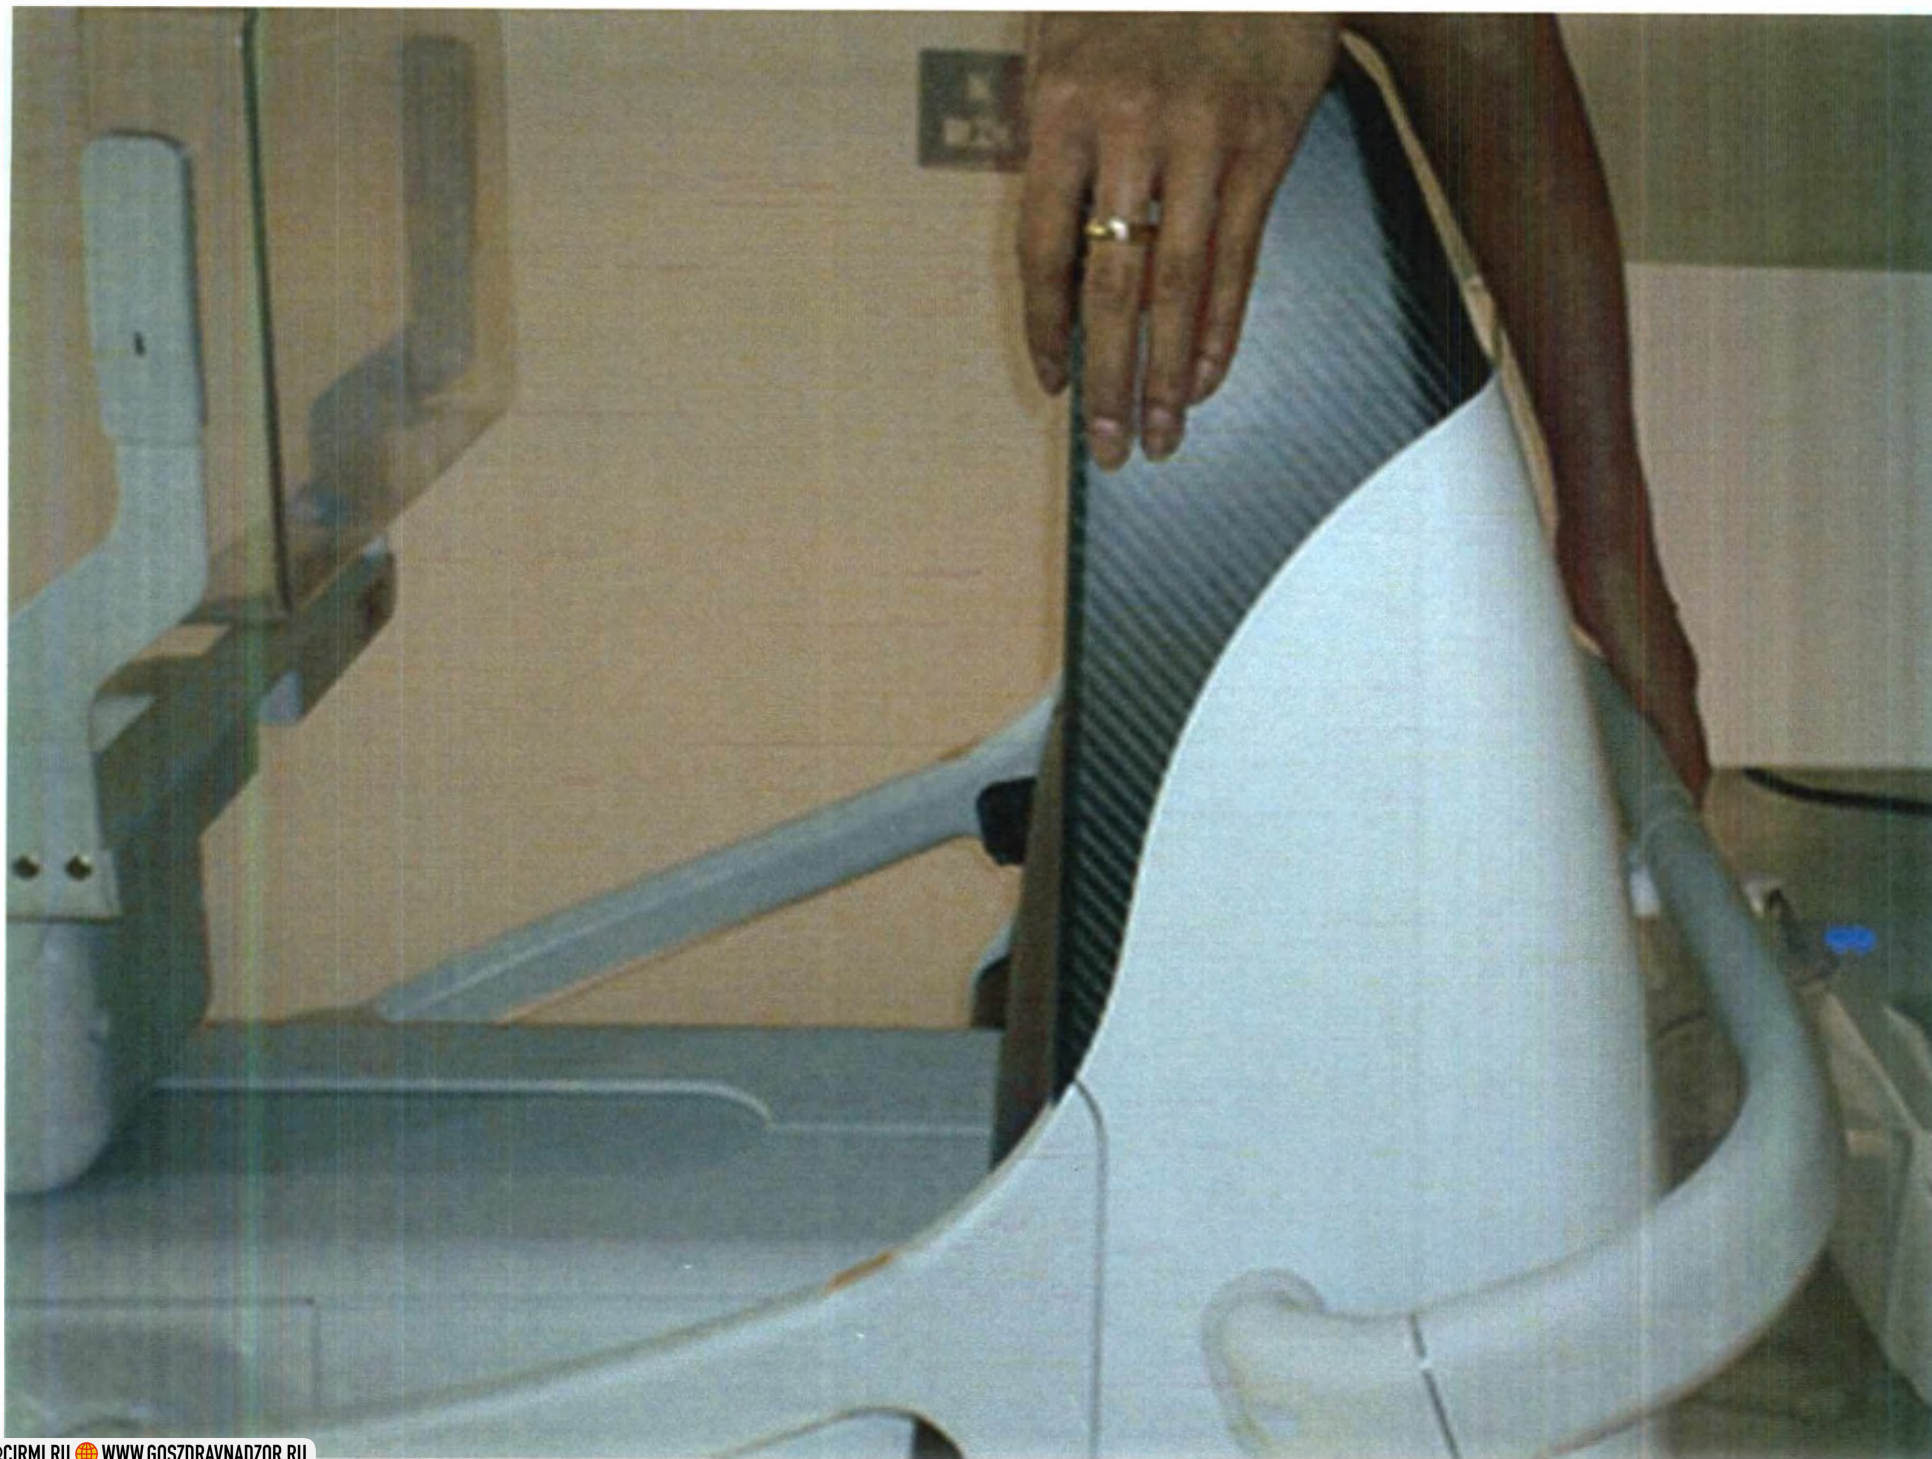

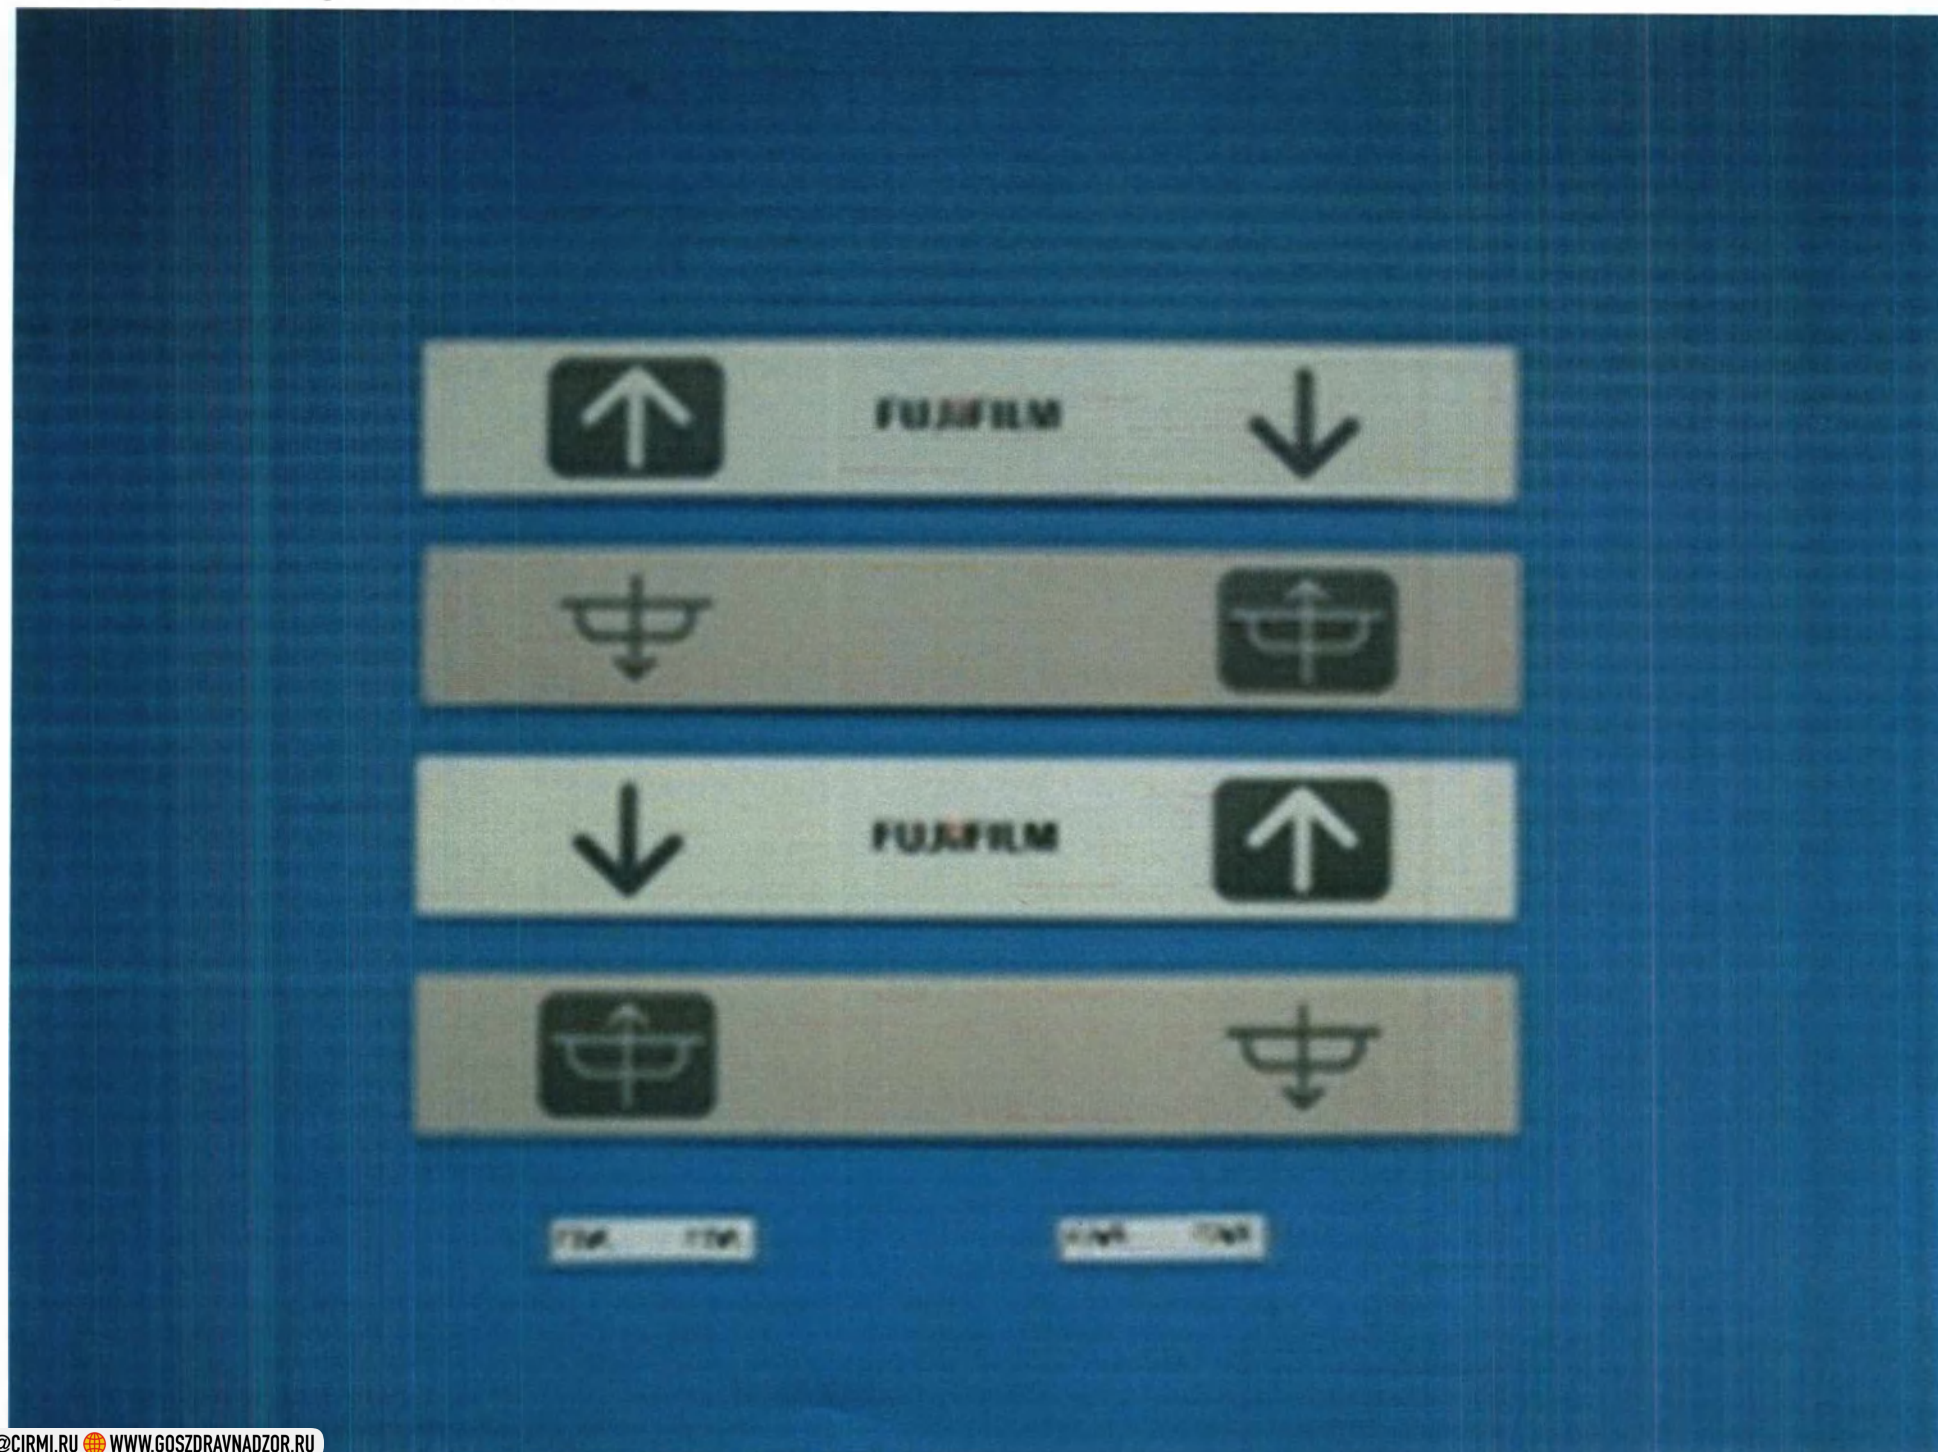


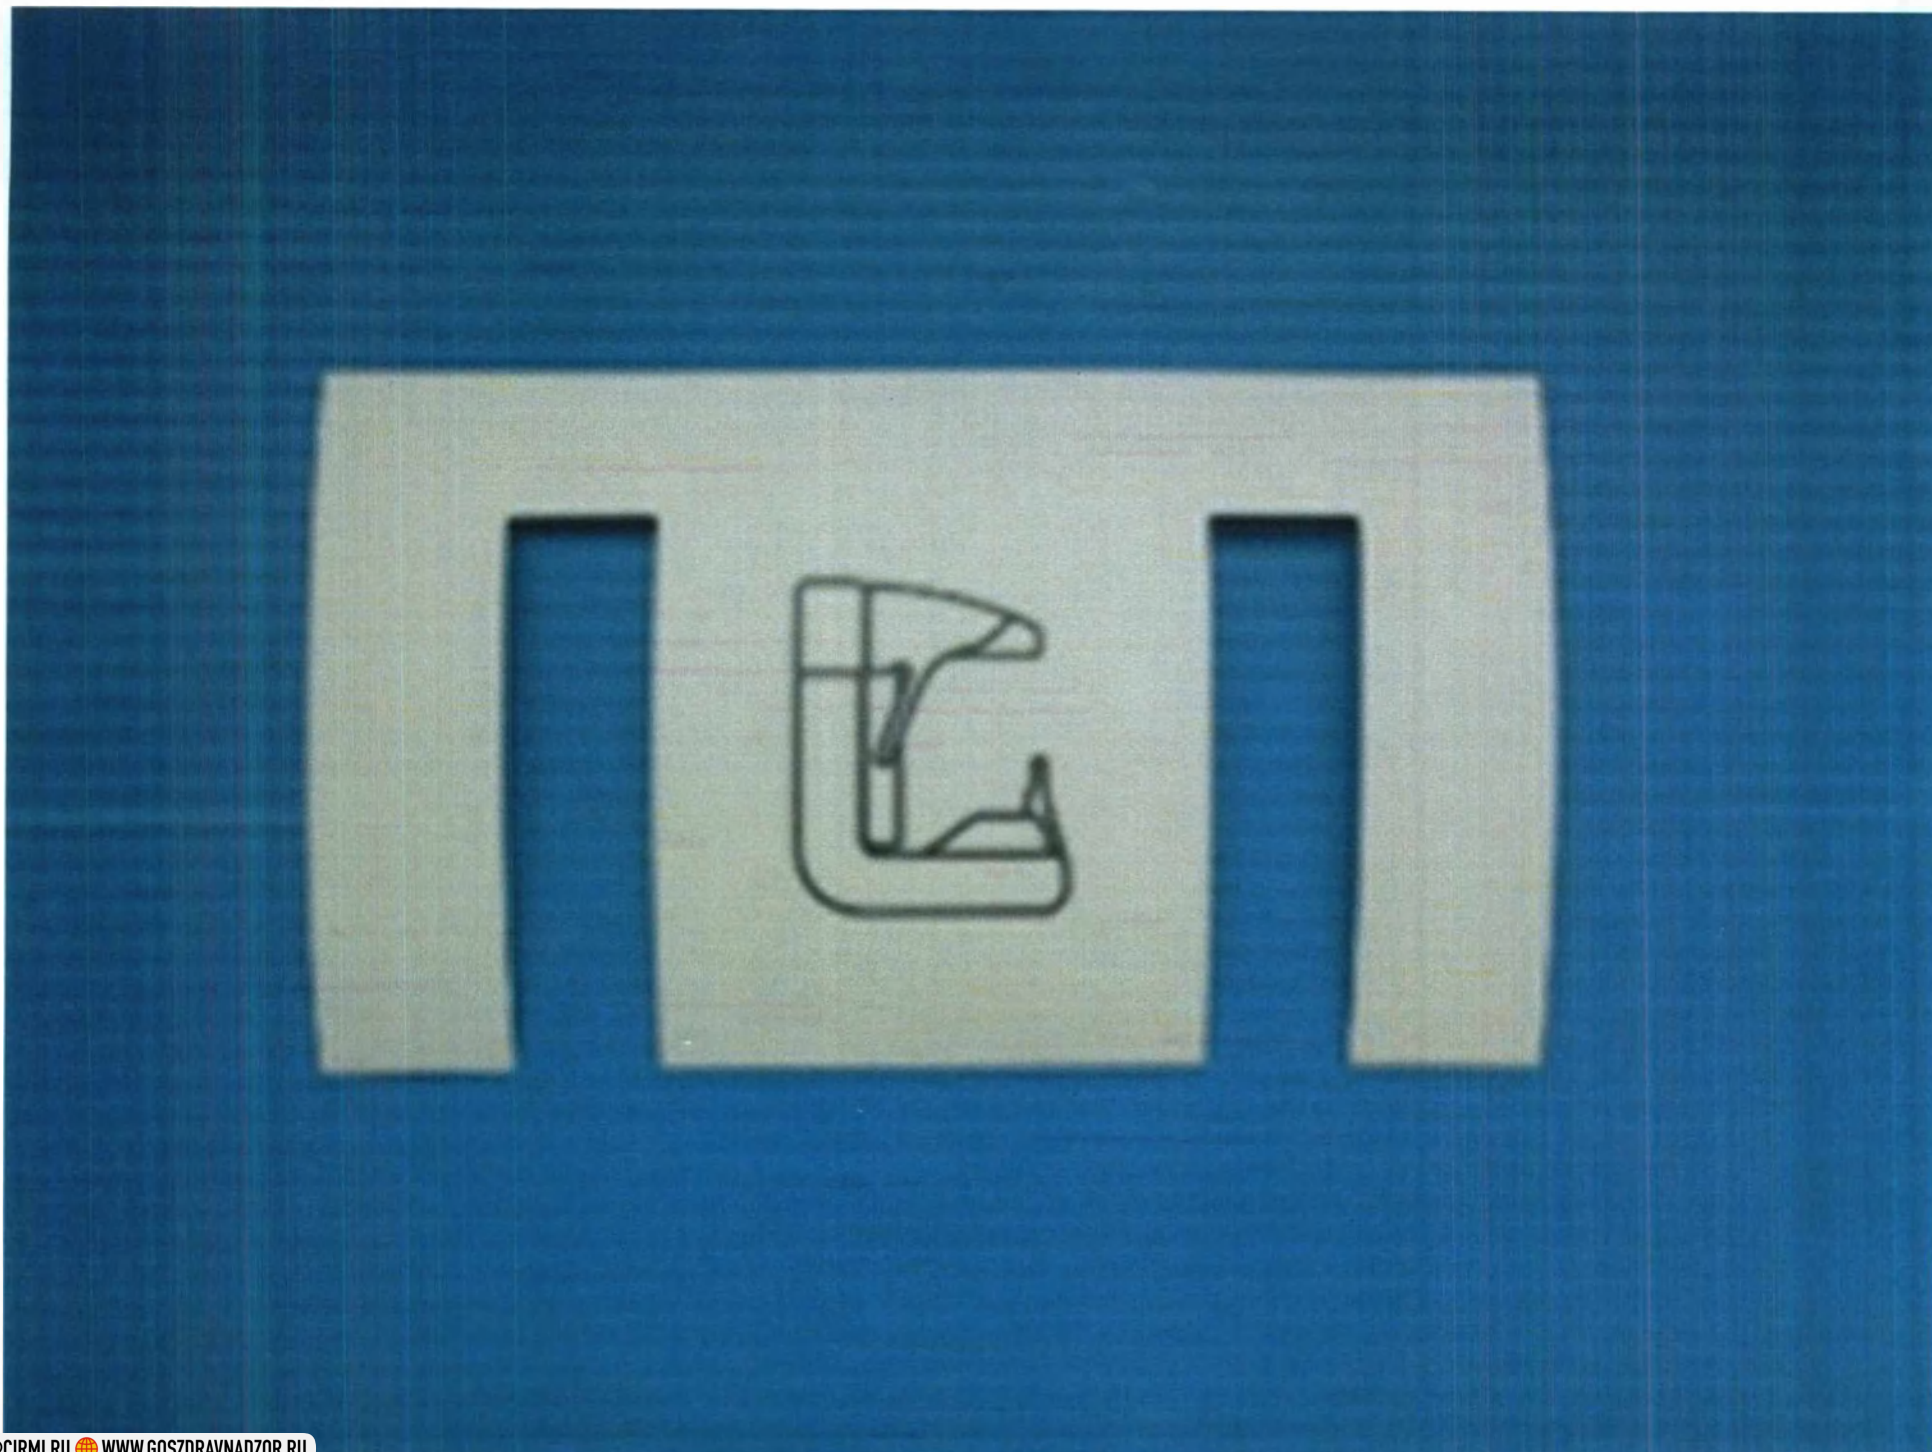


46. Набор для изменения функционала педалей ножного переключателя:
- соединительные провода не более 2 шт.

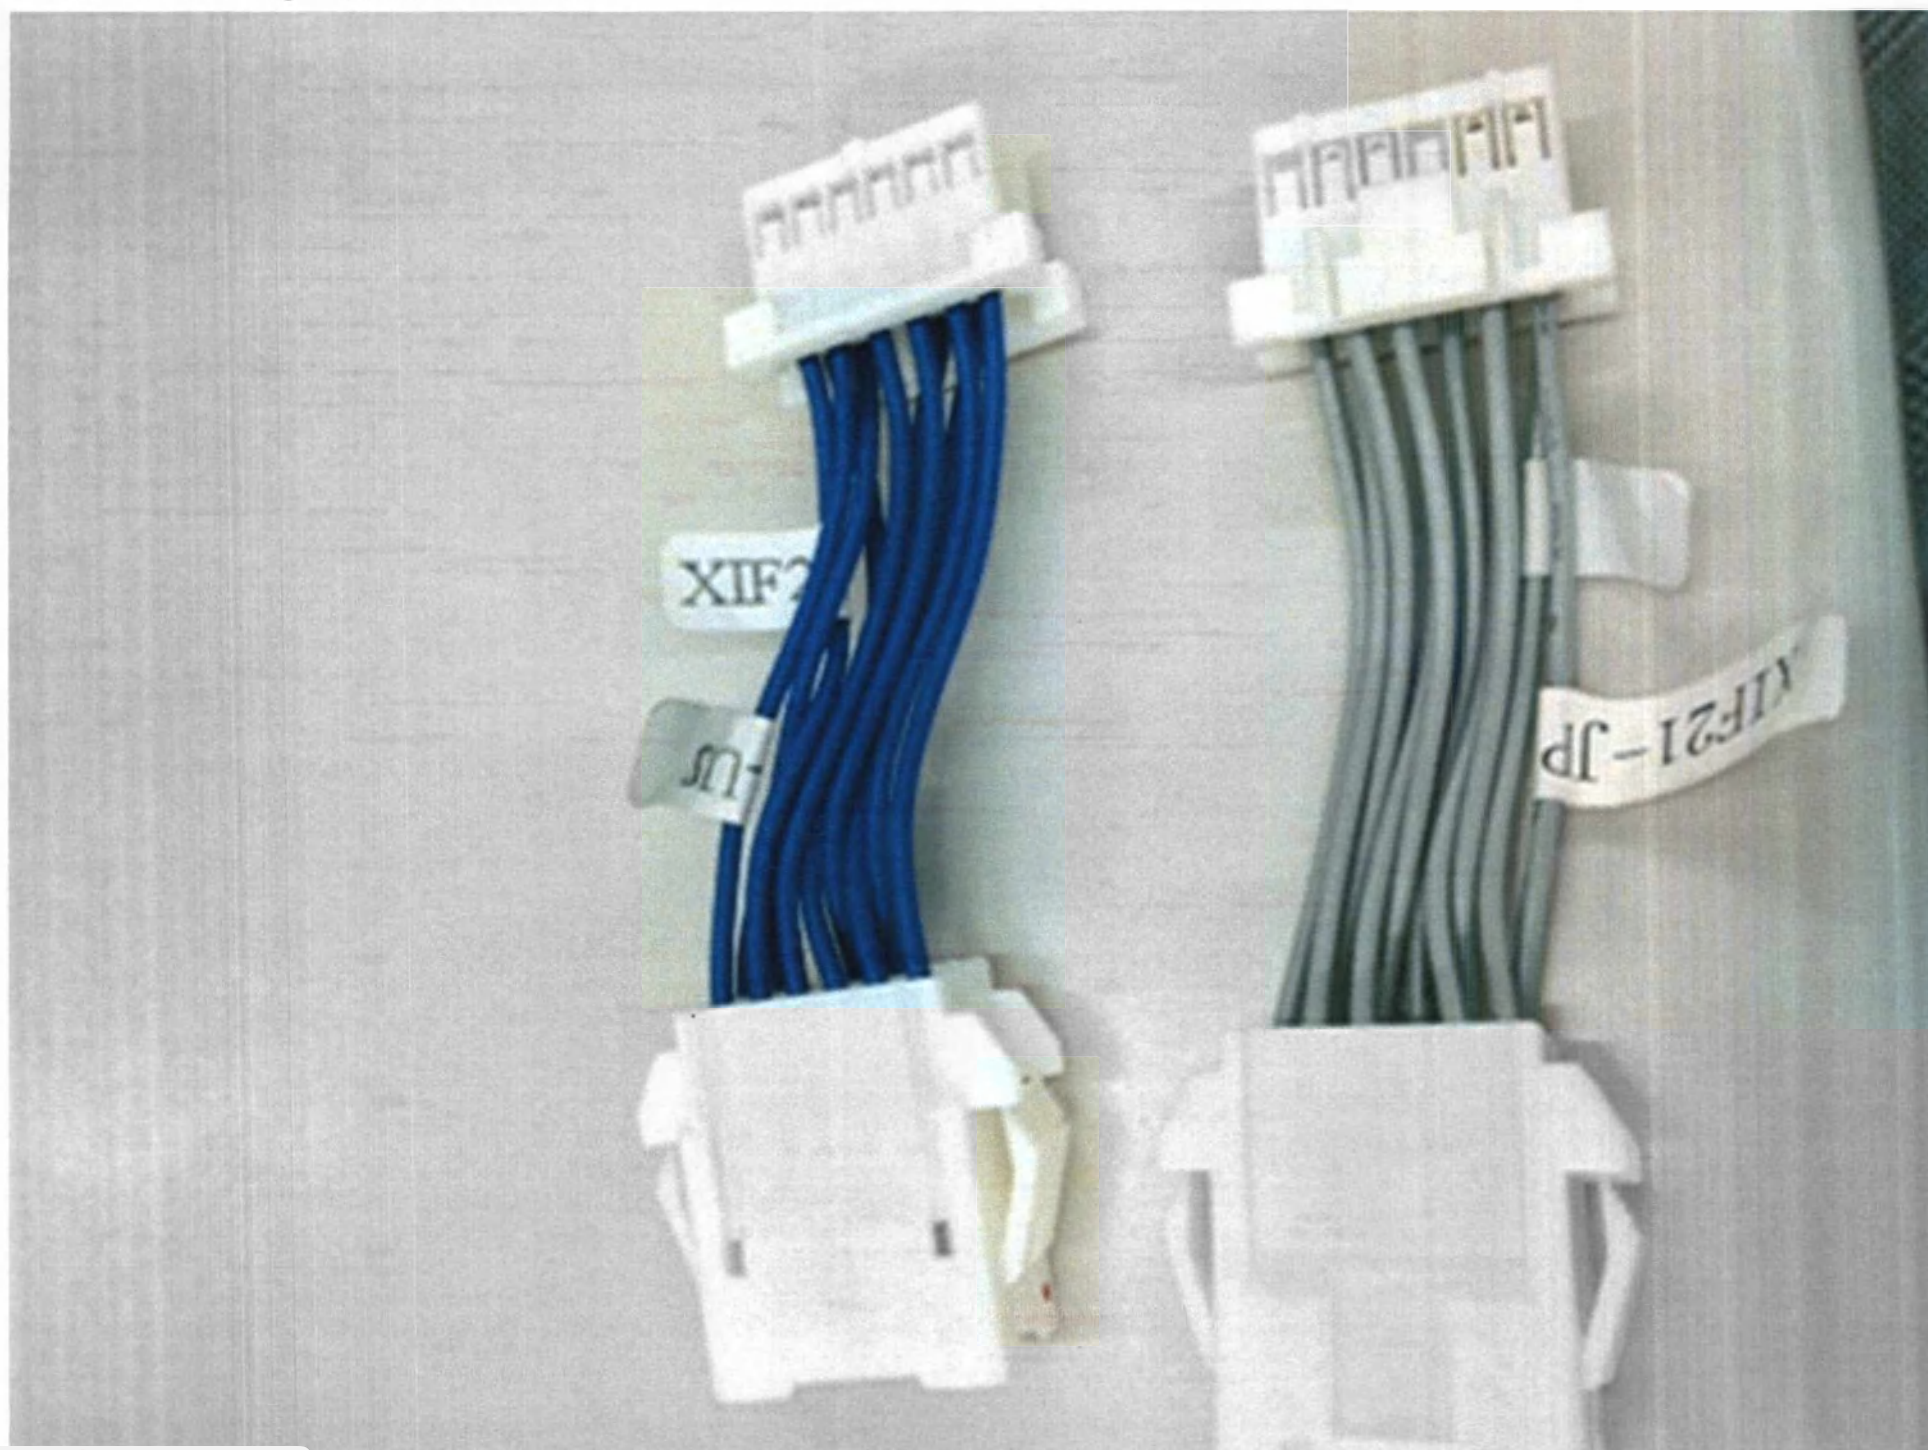


47. Программное обеспечение рабочей станции врача - не более 5 шт.

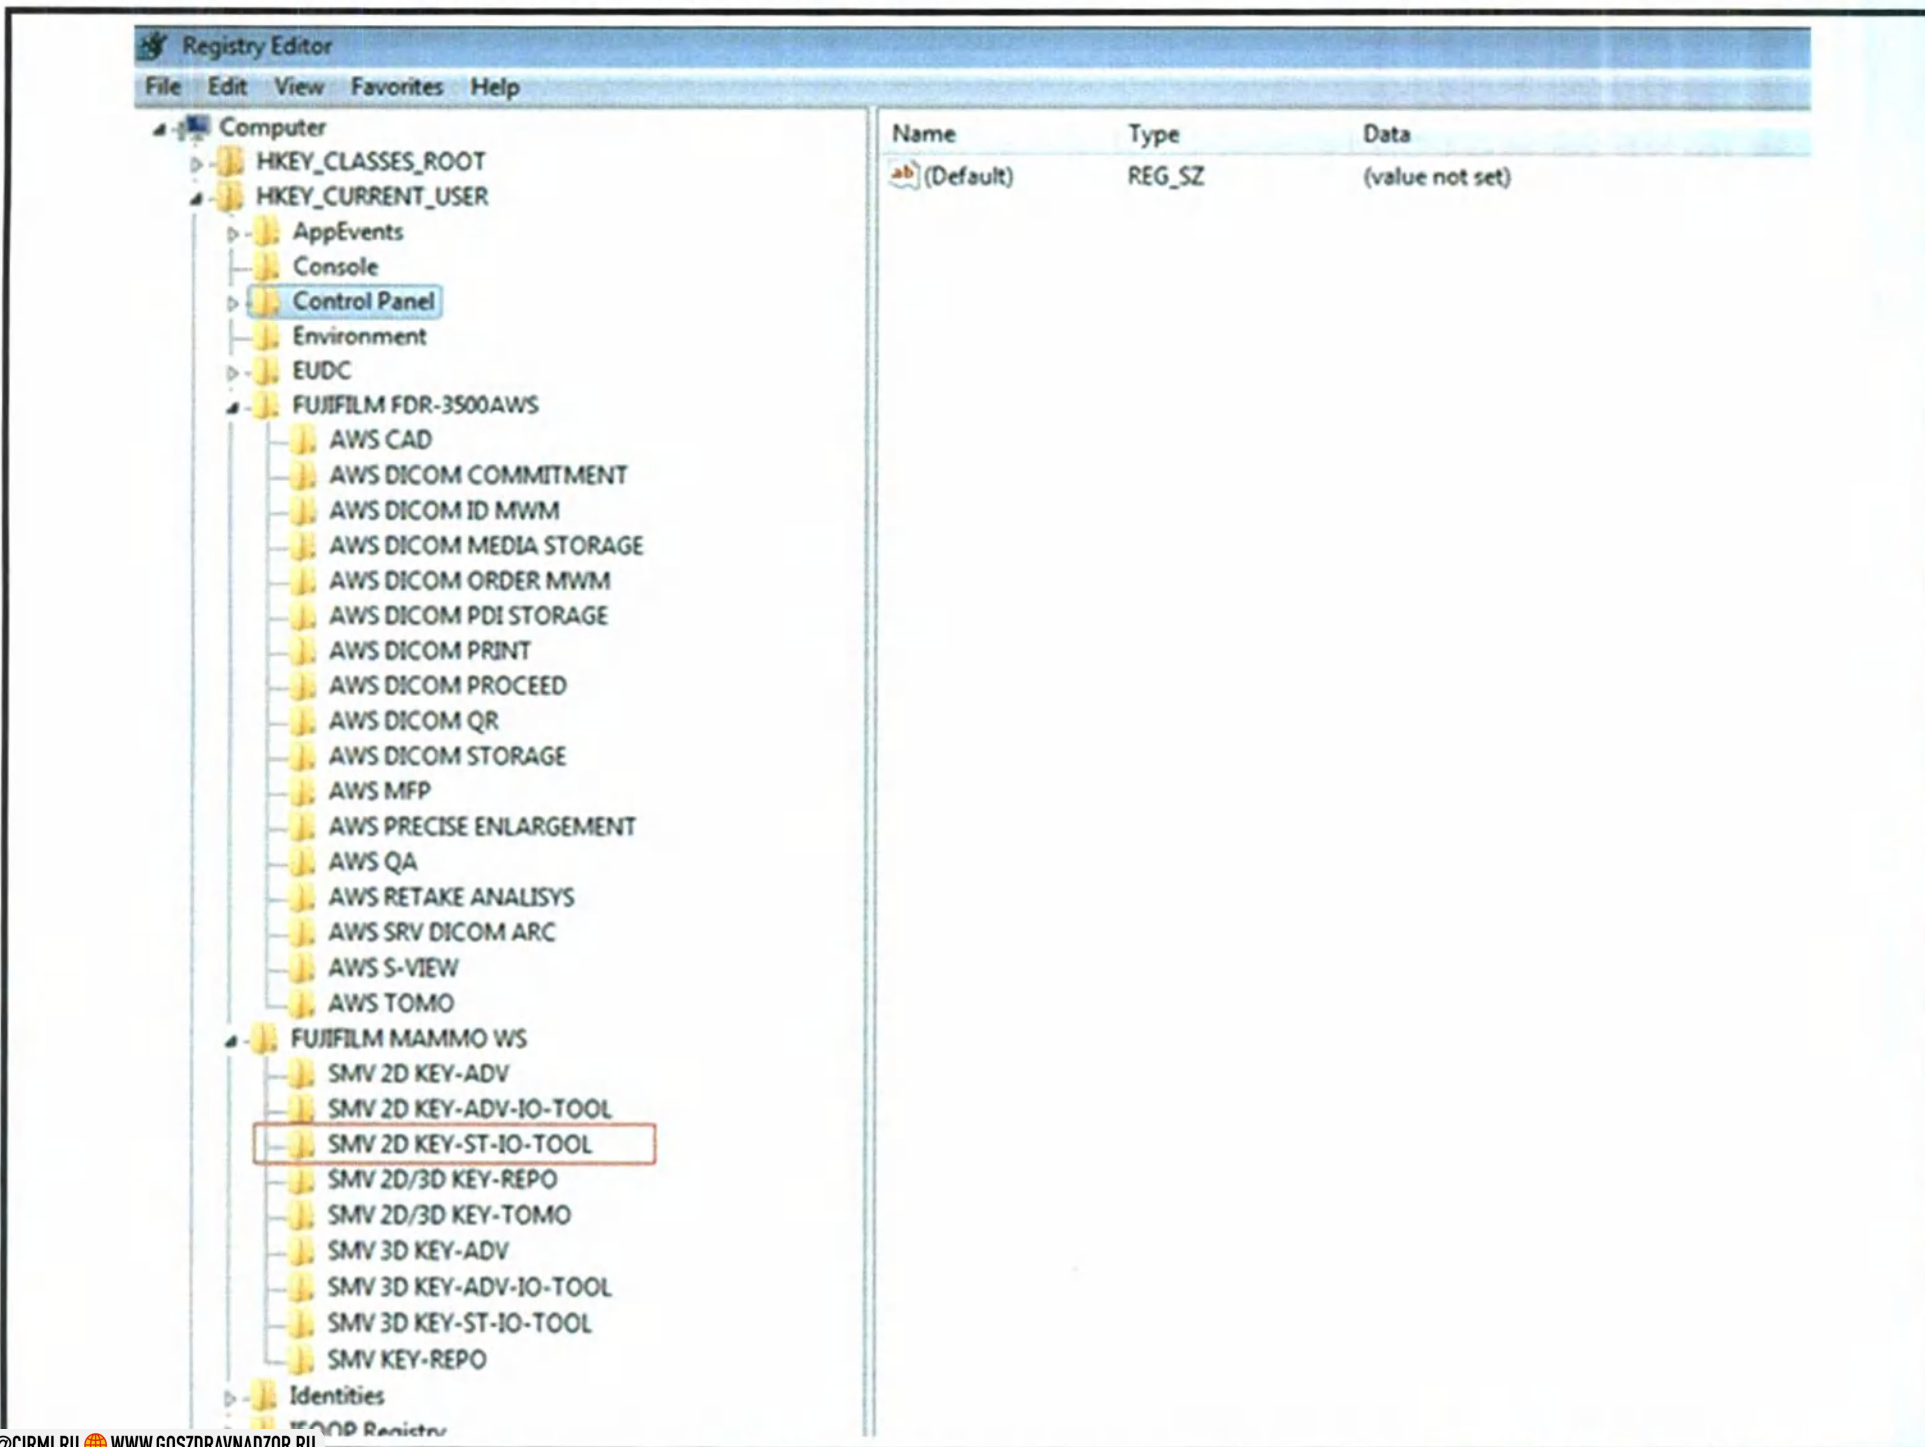

48. Программное обеспечение на набор инструментов отчетности для рабочей станции врача - не более 5 шт.

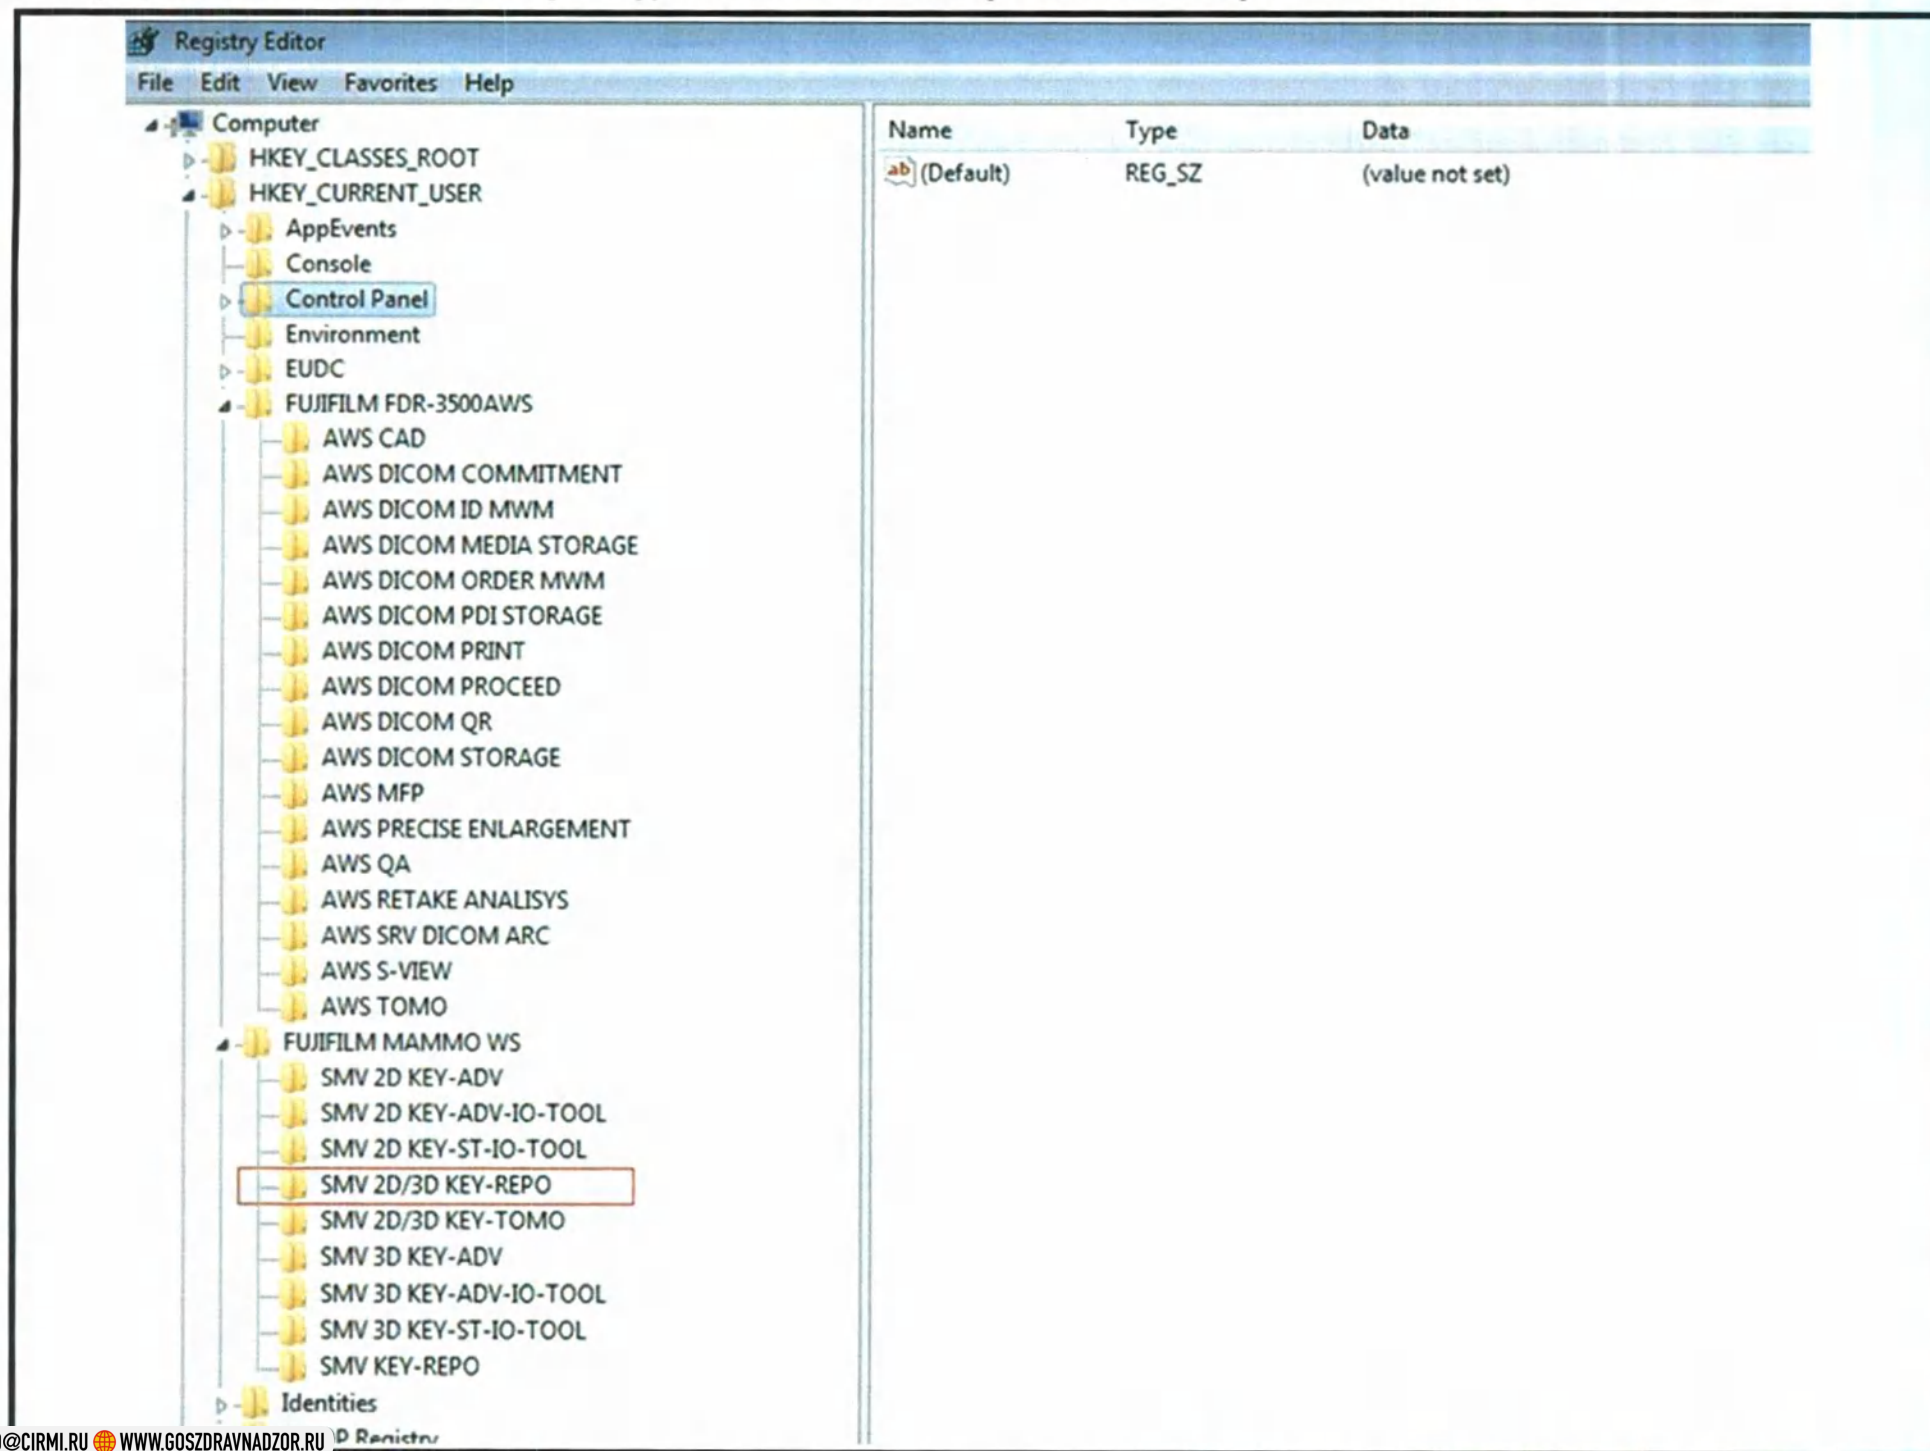


49. Программное обеспечение расширенного набора инструментов для рабочей станции врача - не более 5 шт.

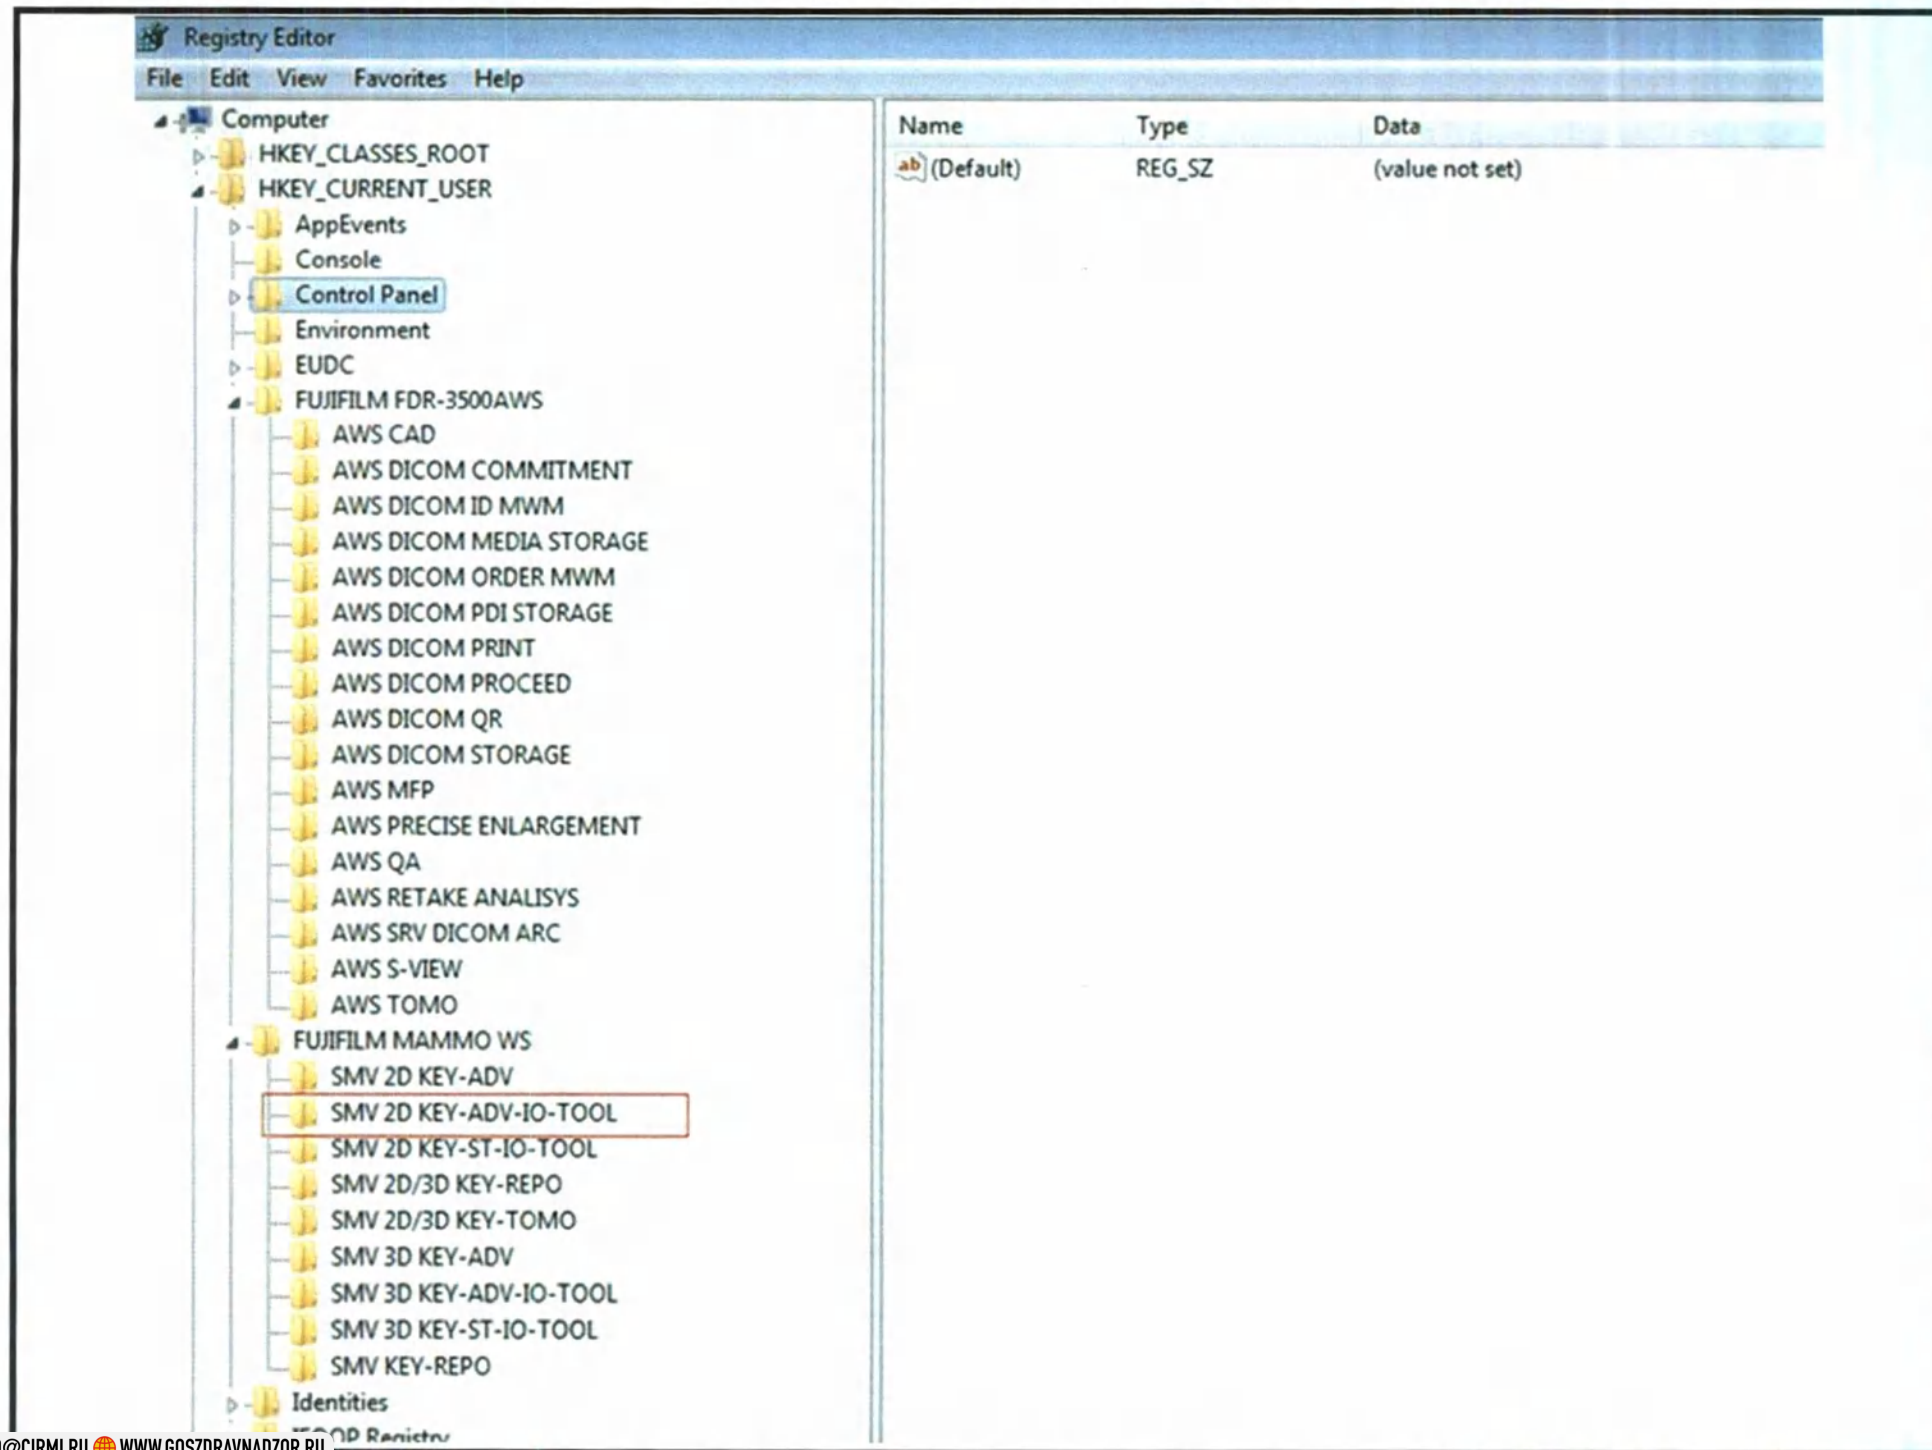


50. Программное обеспечение функции контрастной спектральной маммографии - не более 5 шт.




50. Программное обеспечение функции контрастной спектральной маммографии - не более 5 шт.

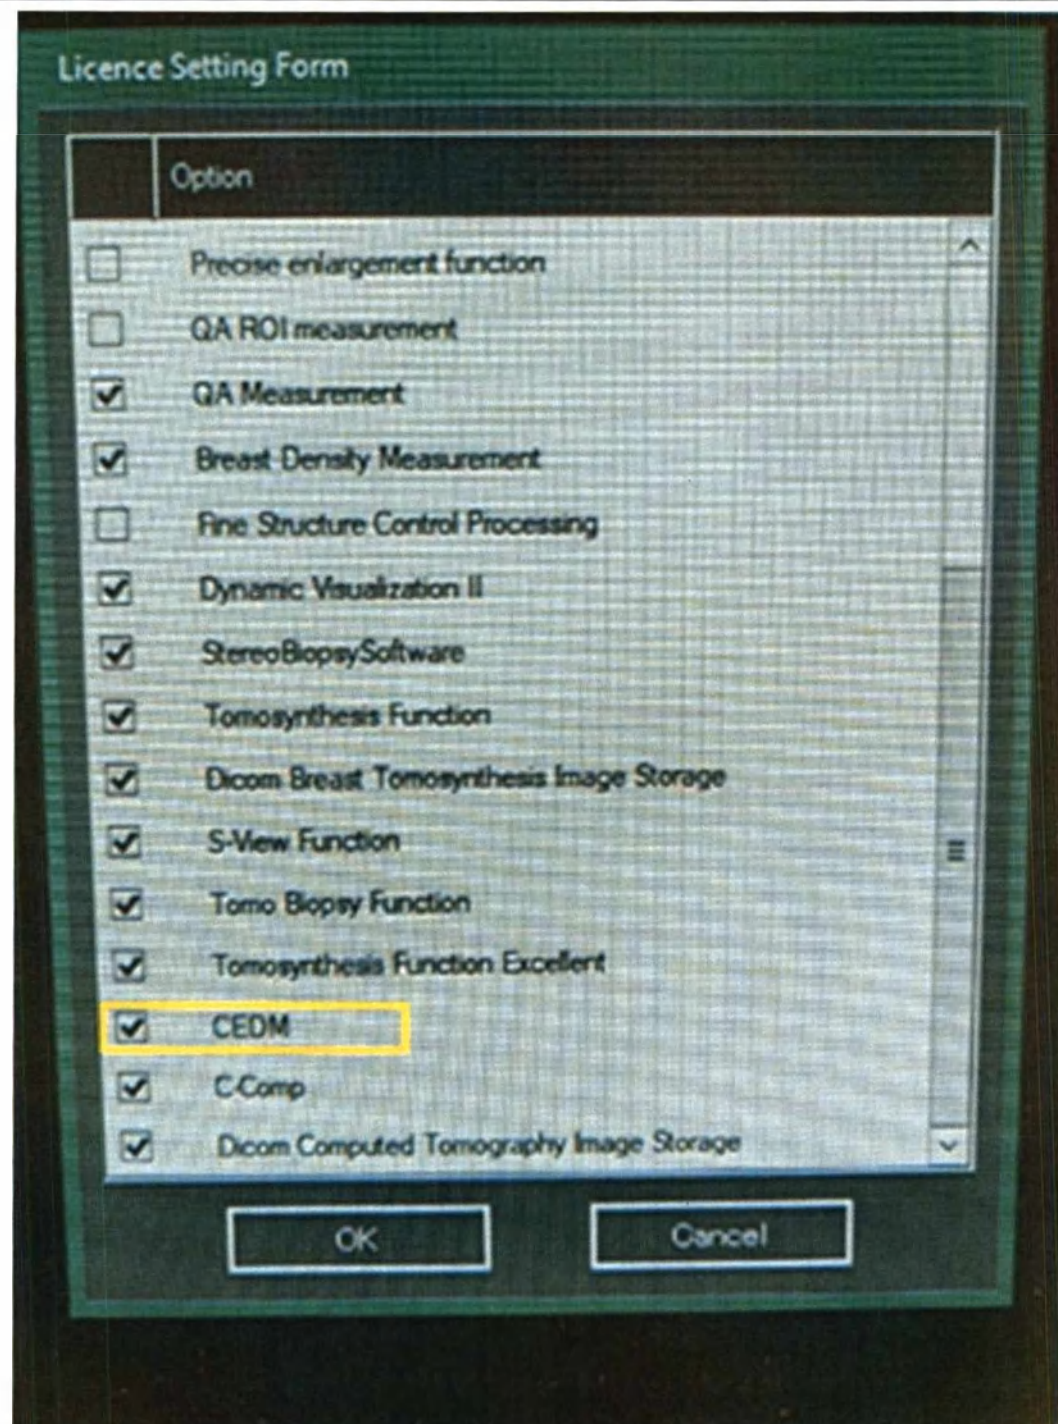


51. Программное обеспечение для биопсии под контролем томосинтеза - не более 5 шт.

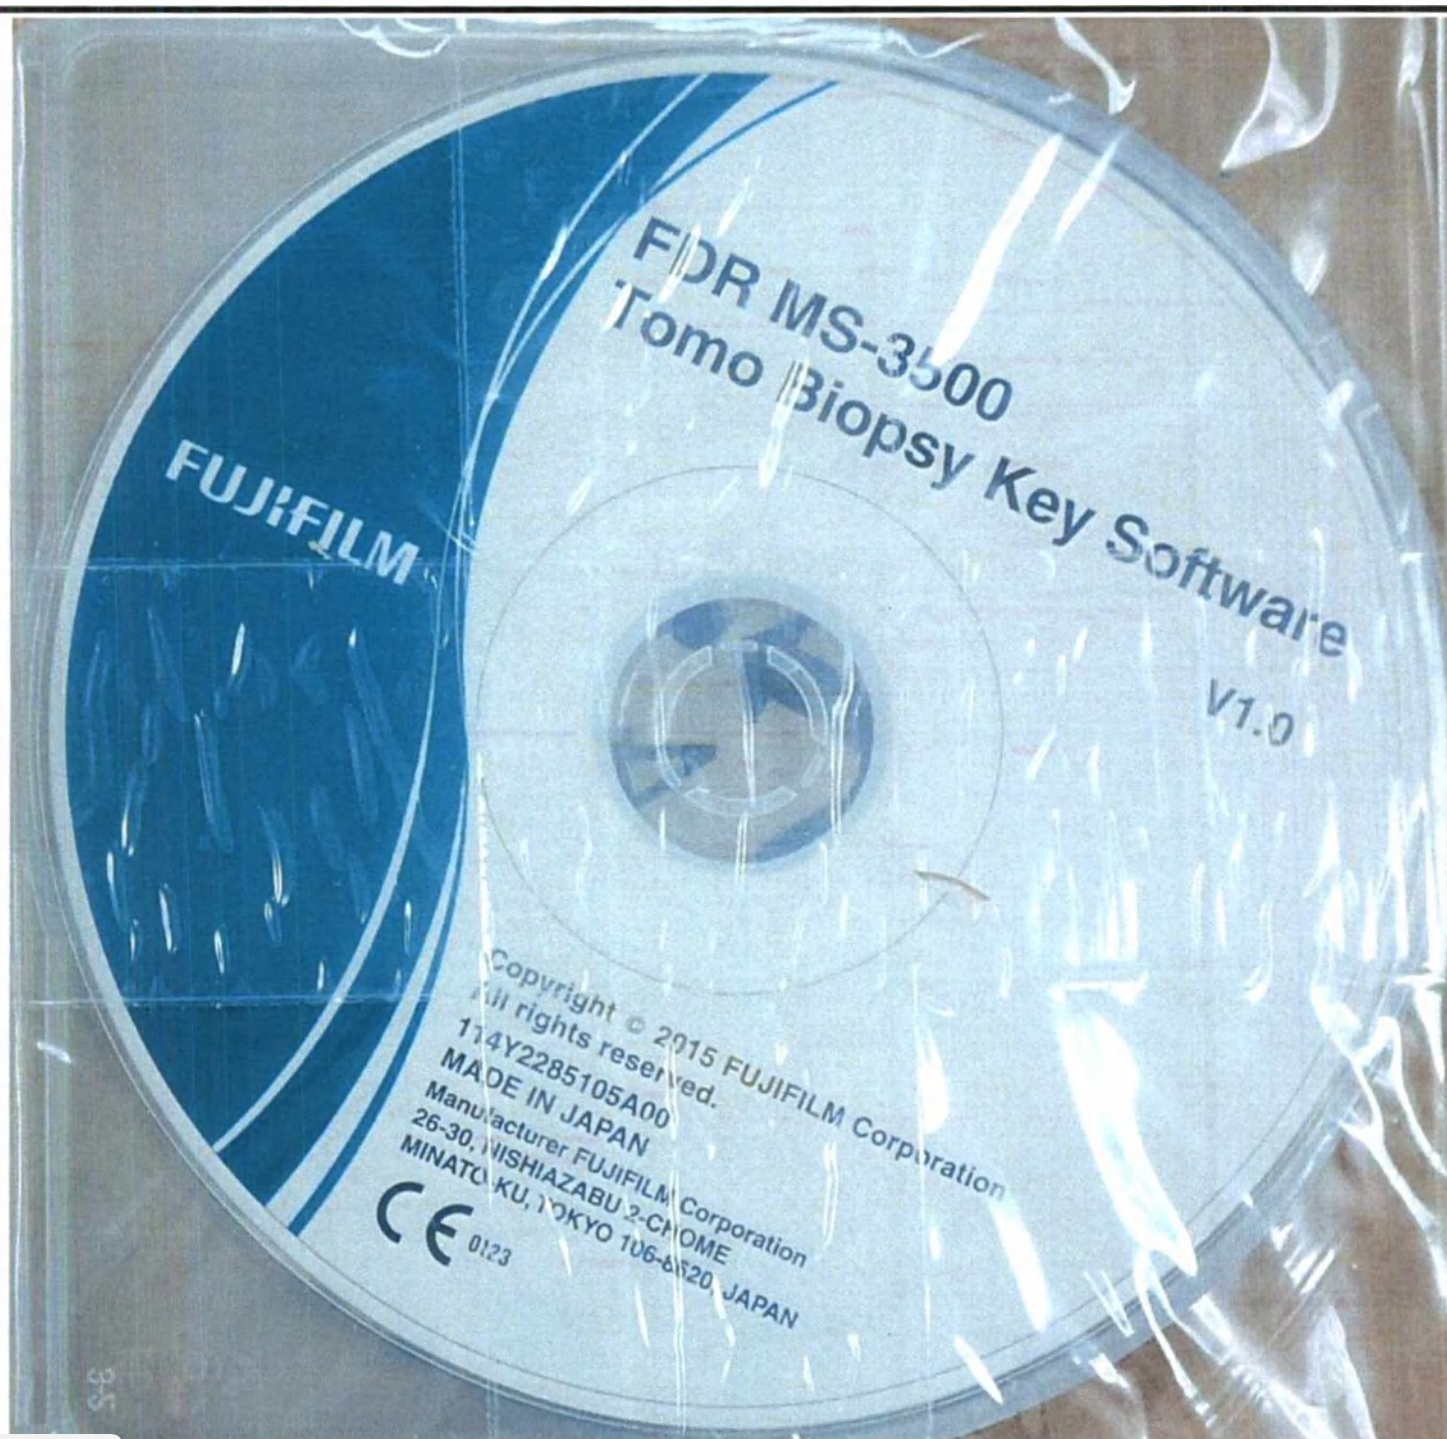


51. Программное обеспечение для биопсии под контролем томосинтеза - не более 5 шт.

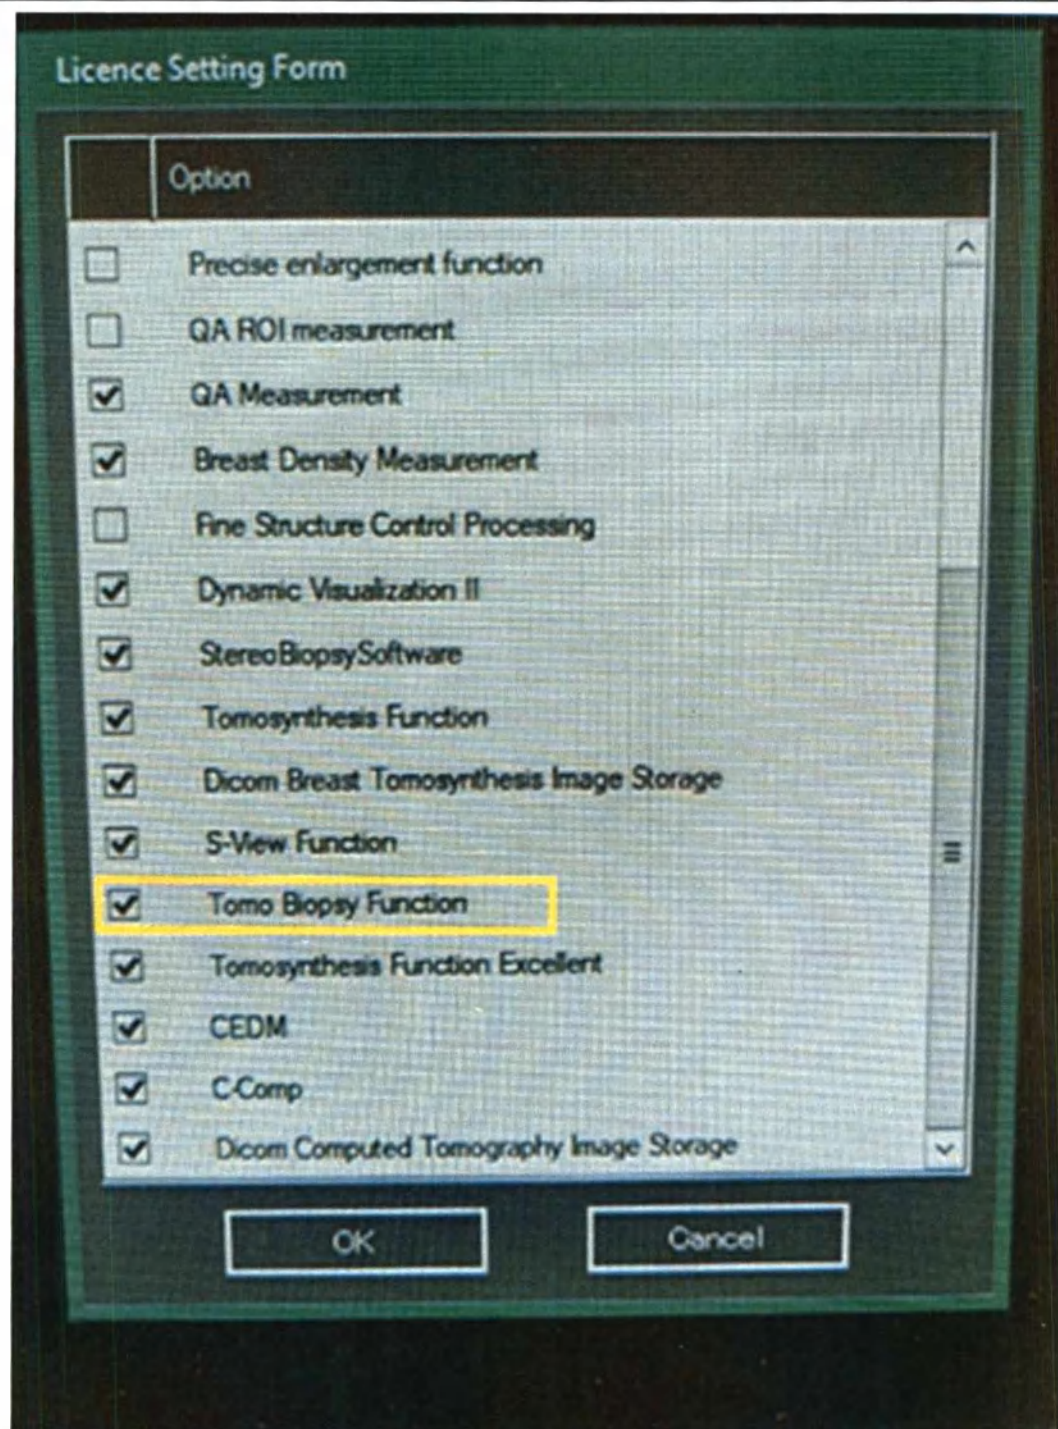


52. Программное обеспечение итеративной реконструкции медицинских диагностических изображений.

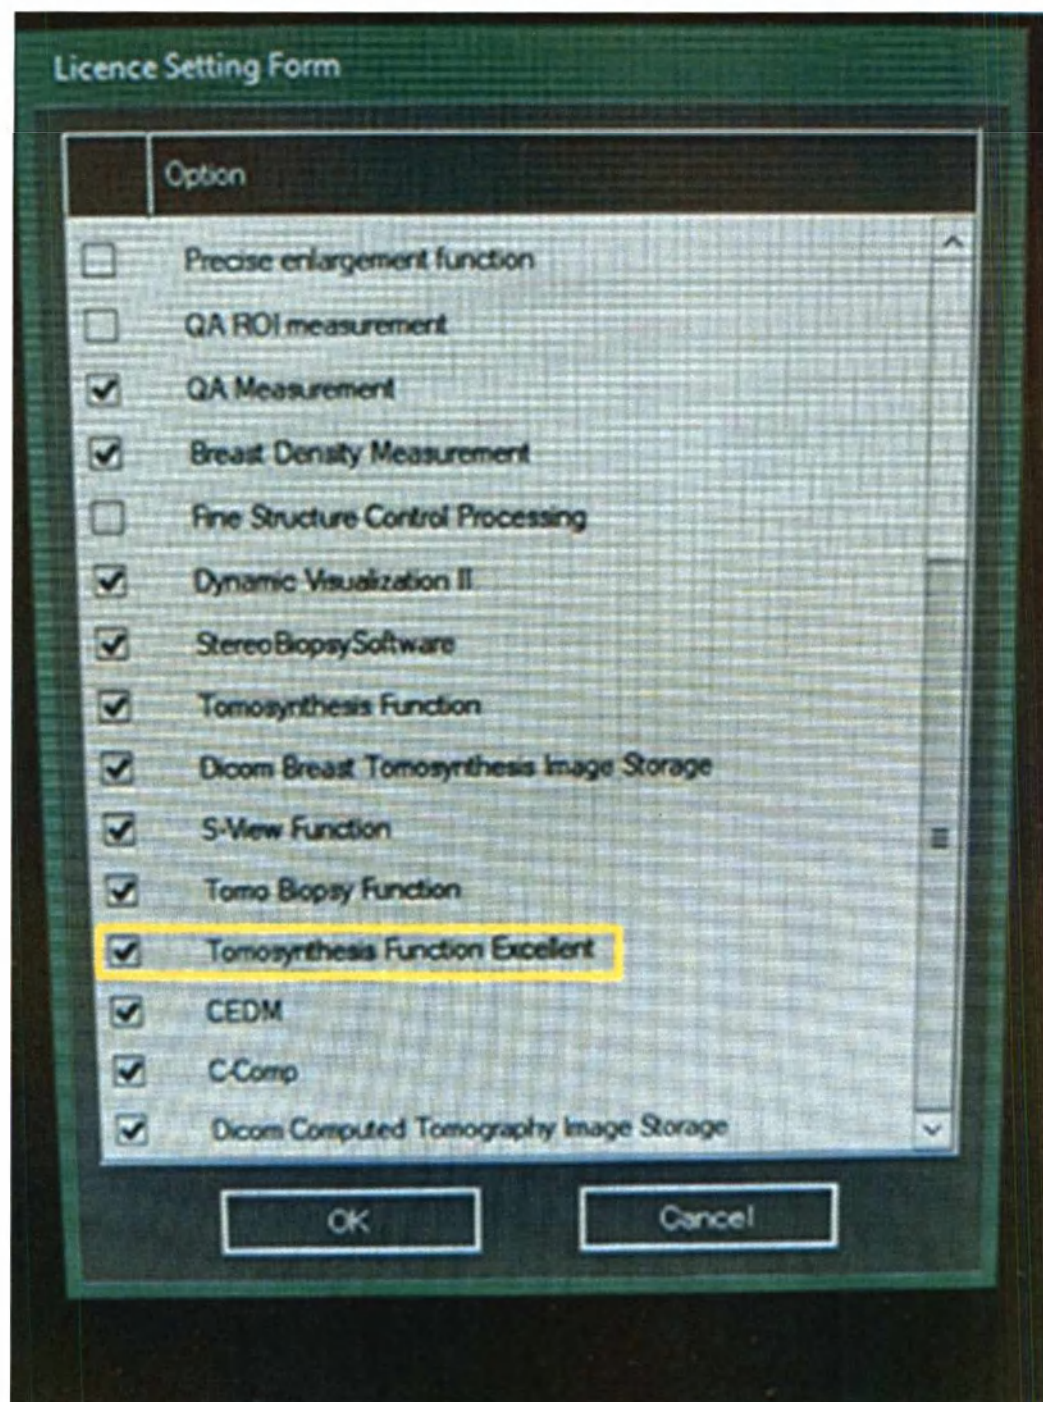


53. Программное обеспечение для печати изображений по DICOM-протоколу.

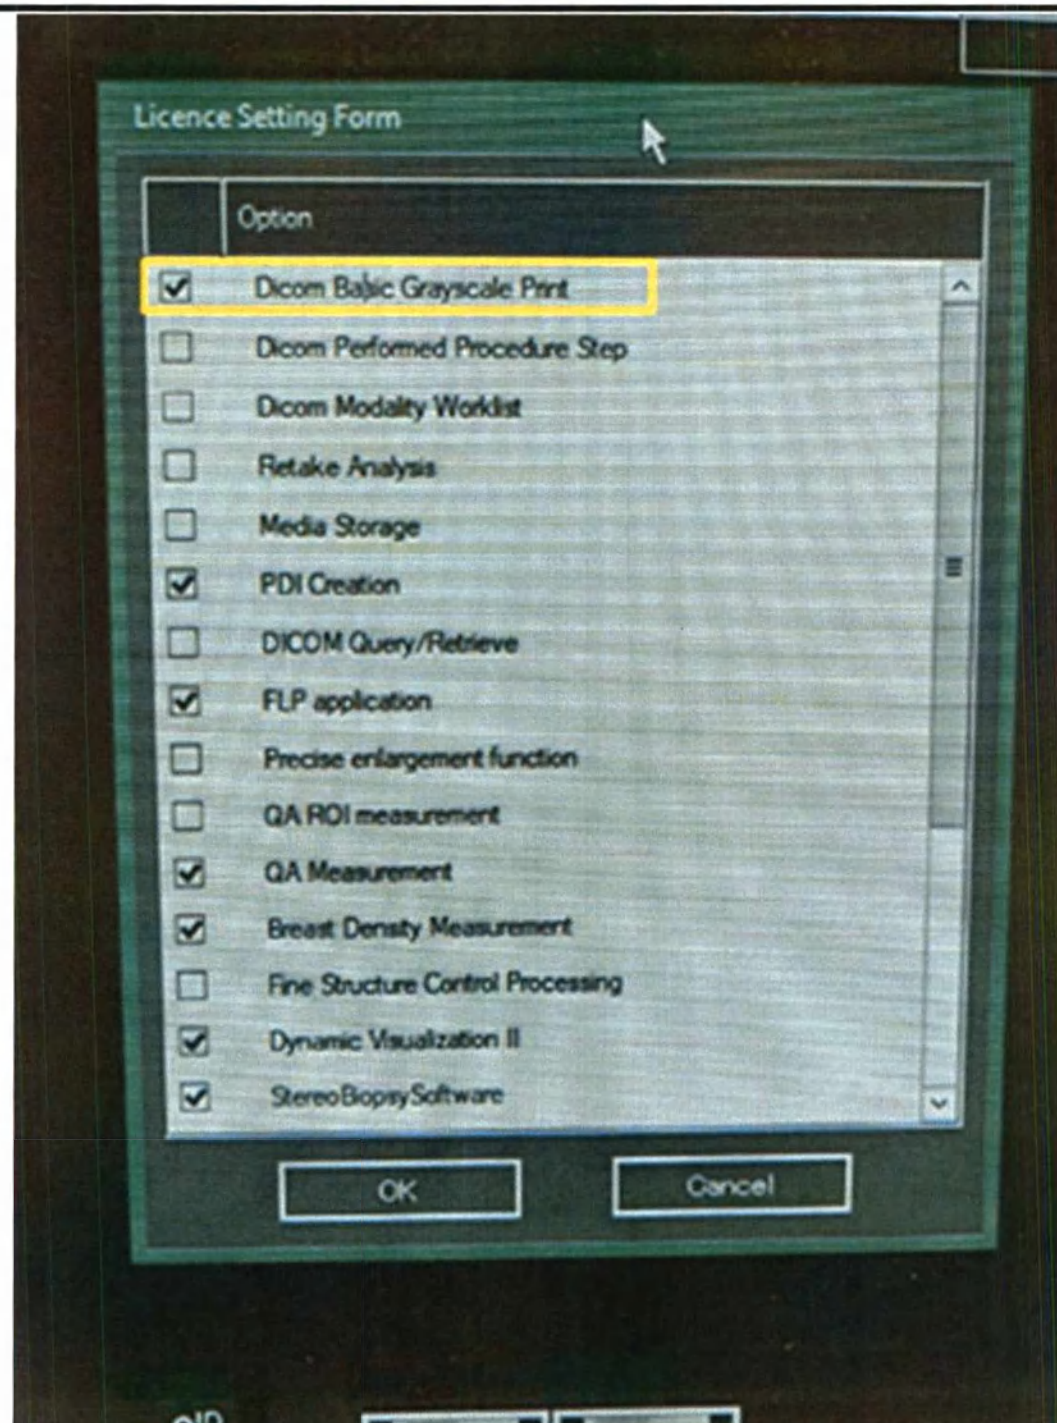


54. Программное обеспечение для получения данных о пациенте с описанием требований с систем HIS и RIS по DICOM-протоколу.

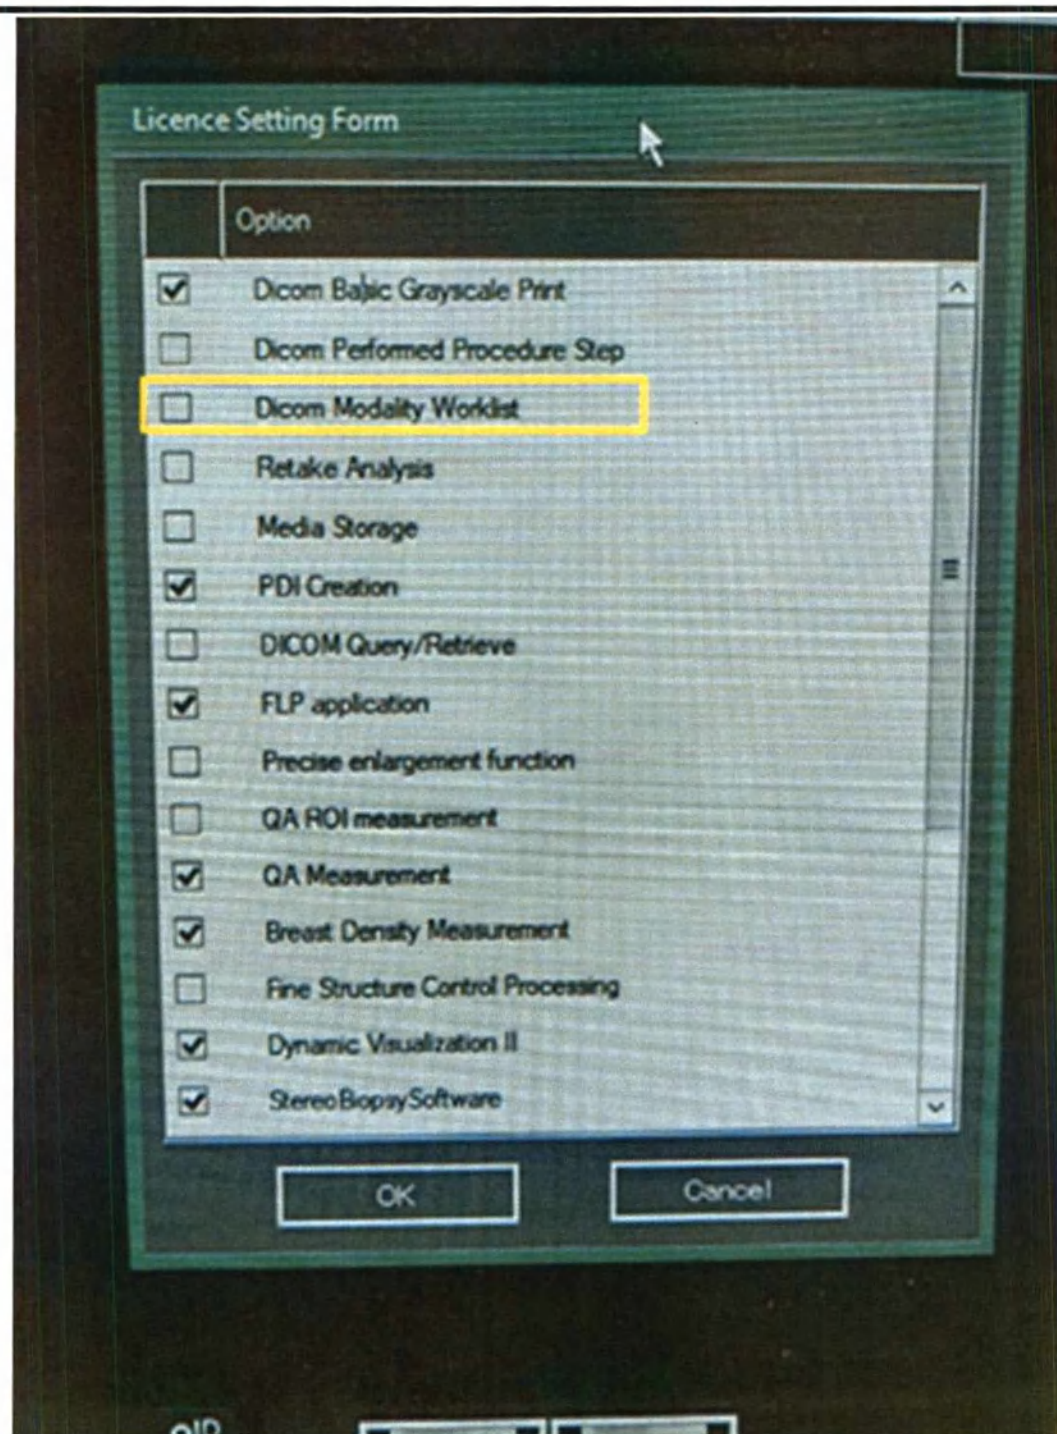


55. Программное обеспечение для записи изображений на медиа-носители в DICOM-протоколе.

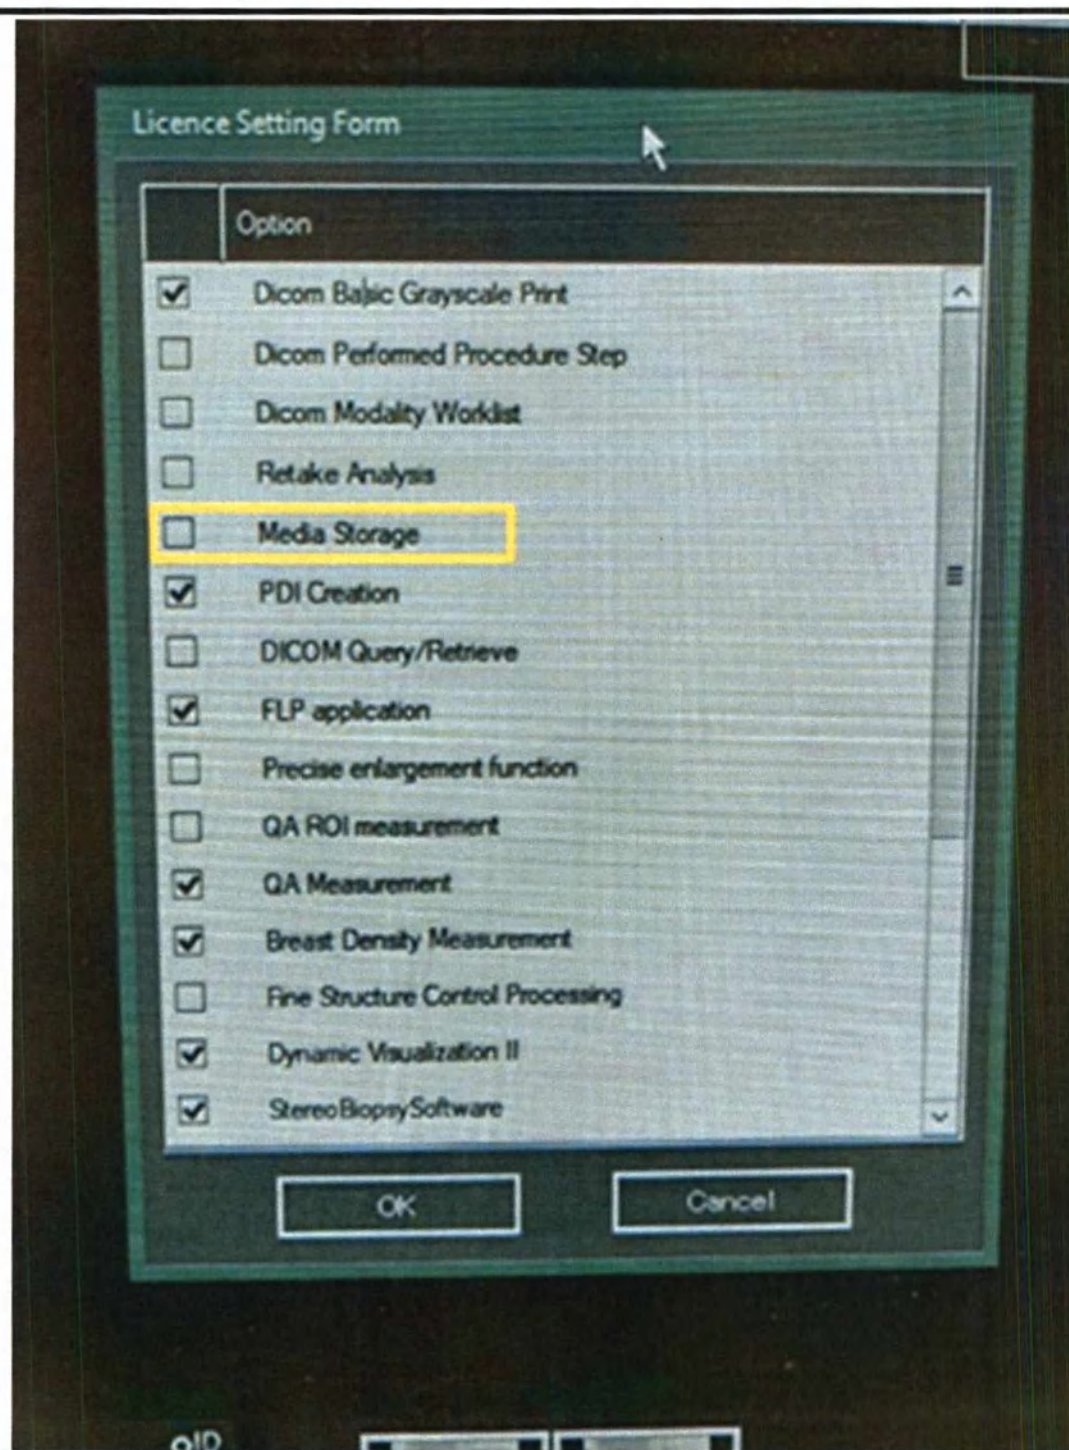


56. Программное обеспечение для записи изображений на медиа-носители с возможностью просмотра на внешнем устройстве.

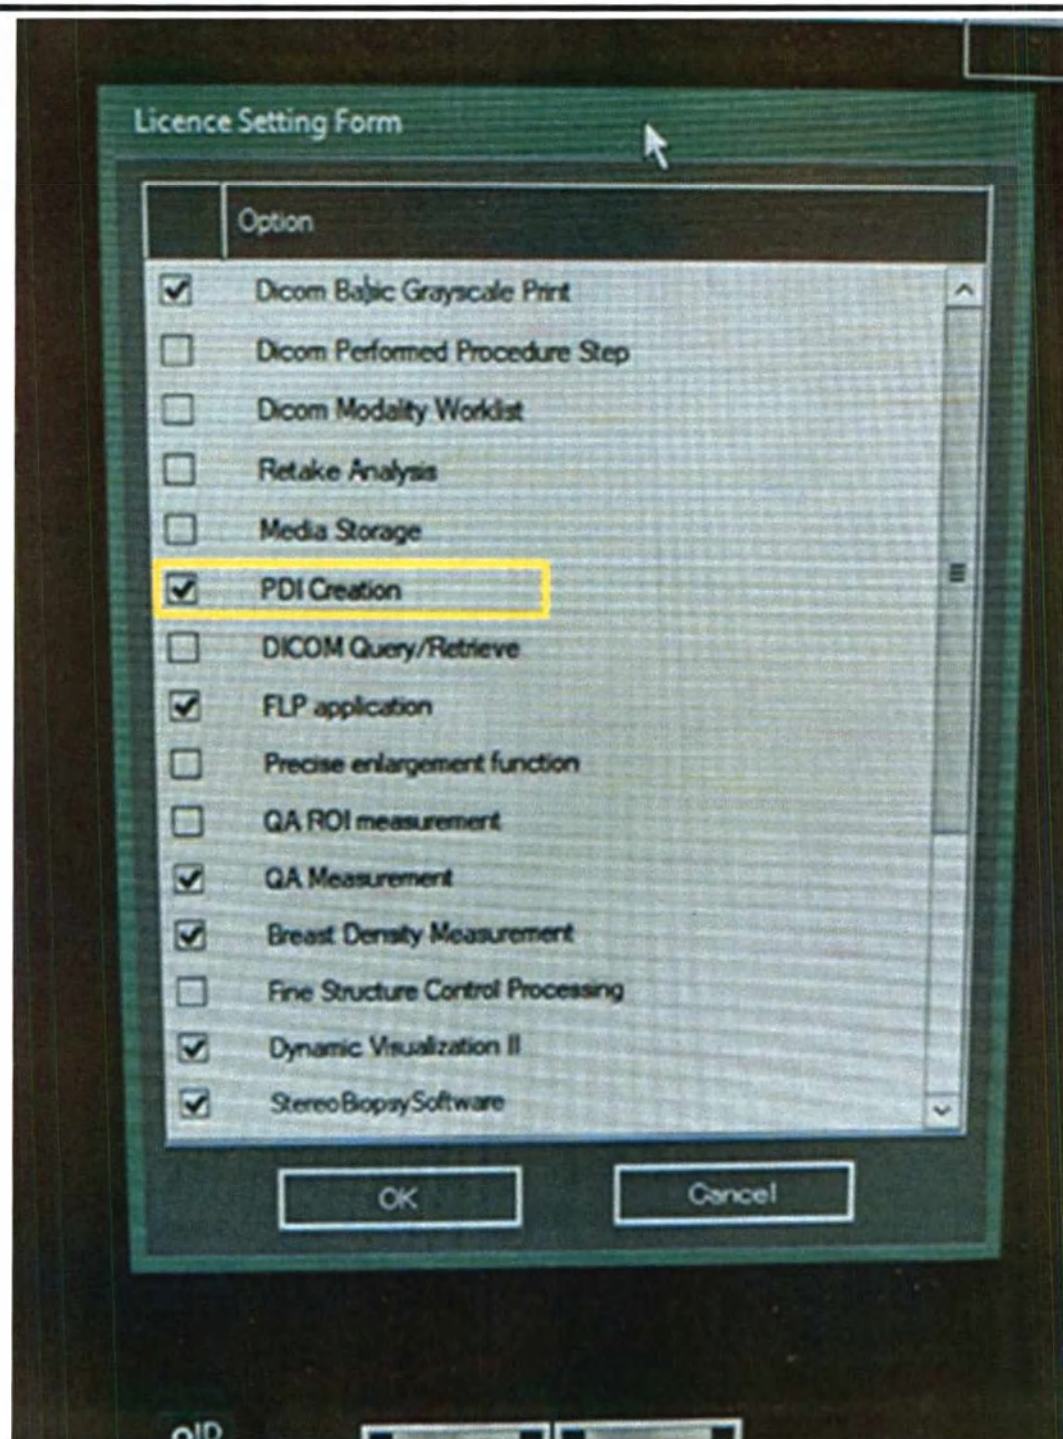


57. Программное обеспечение для визуализации изображений с реальным размером пикселя.

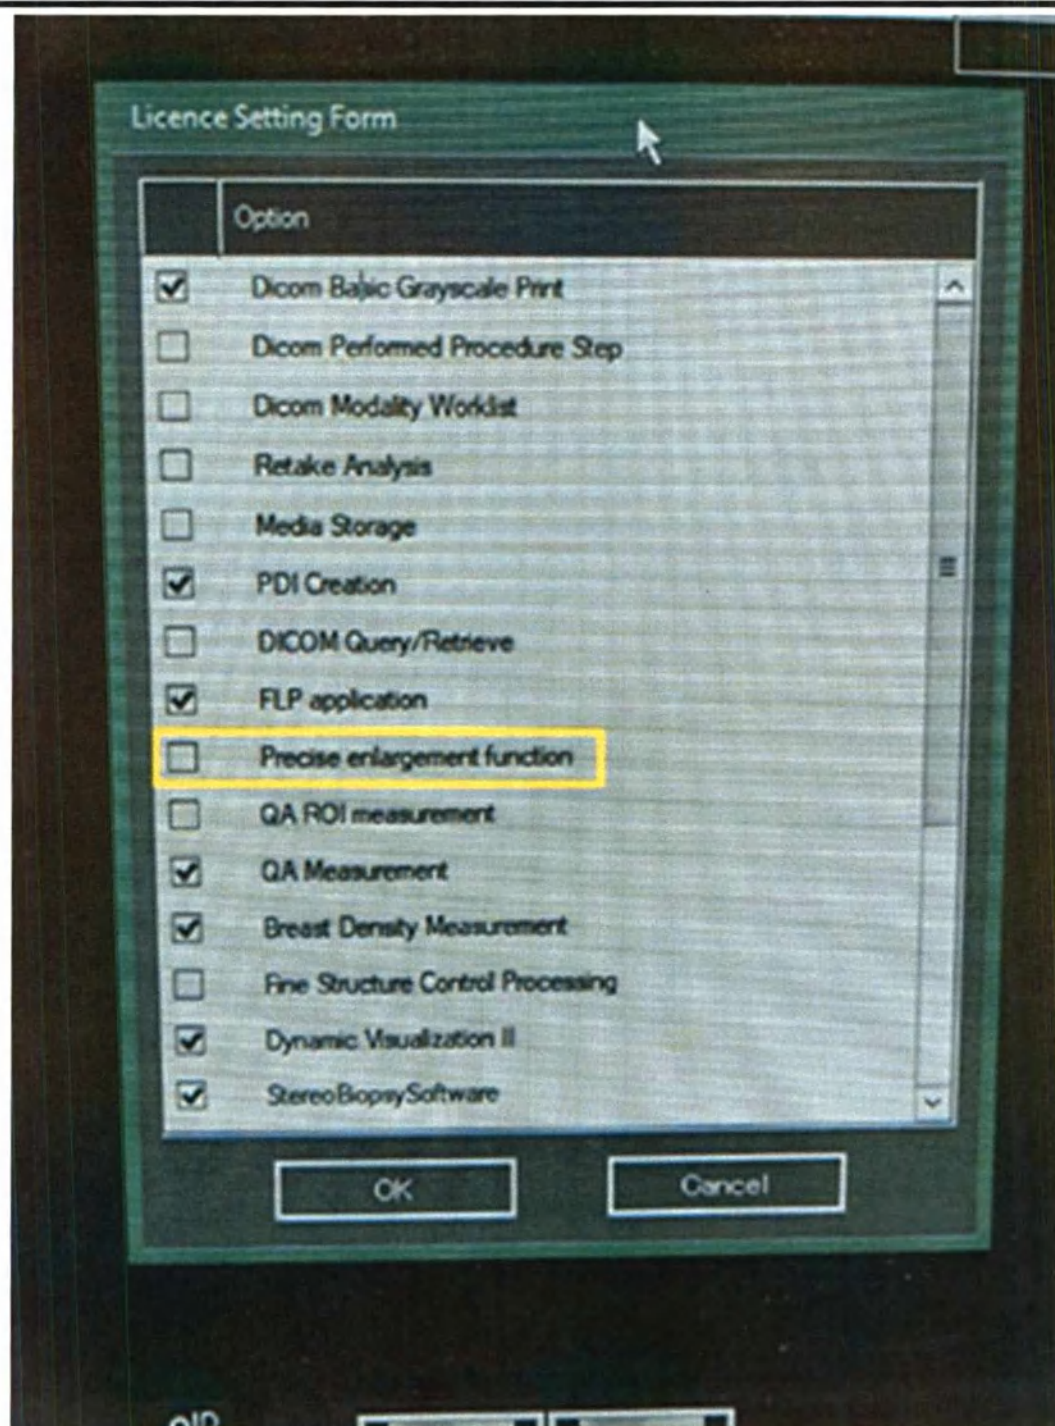


58. Программное обеспечение для связи и обмена данными с удаленным сервером по DICOM-протоколу.

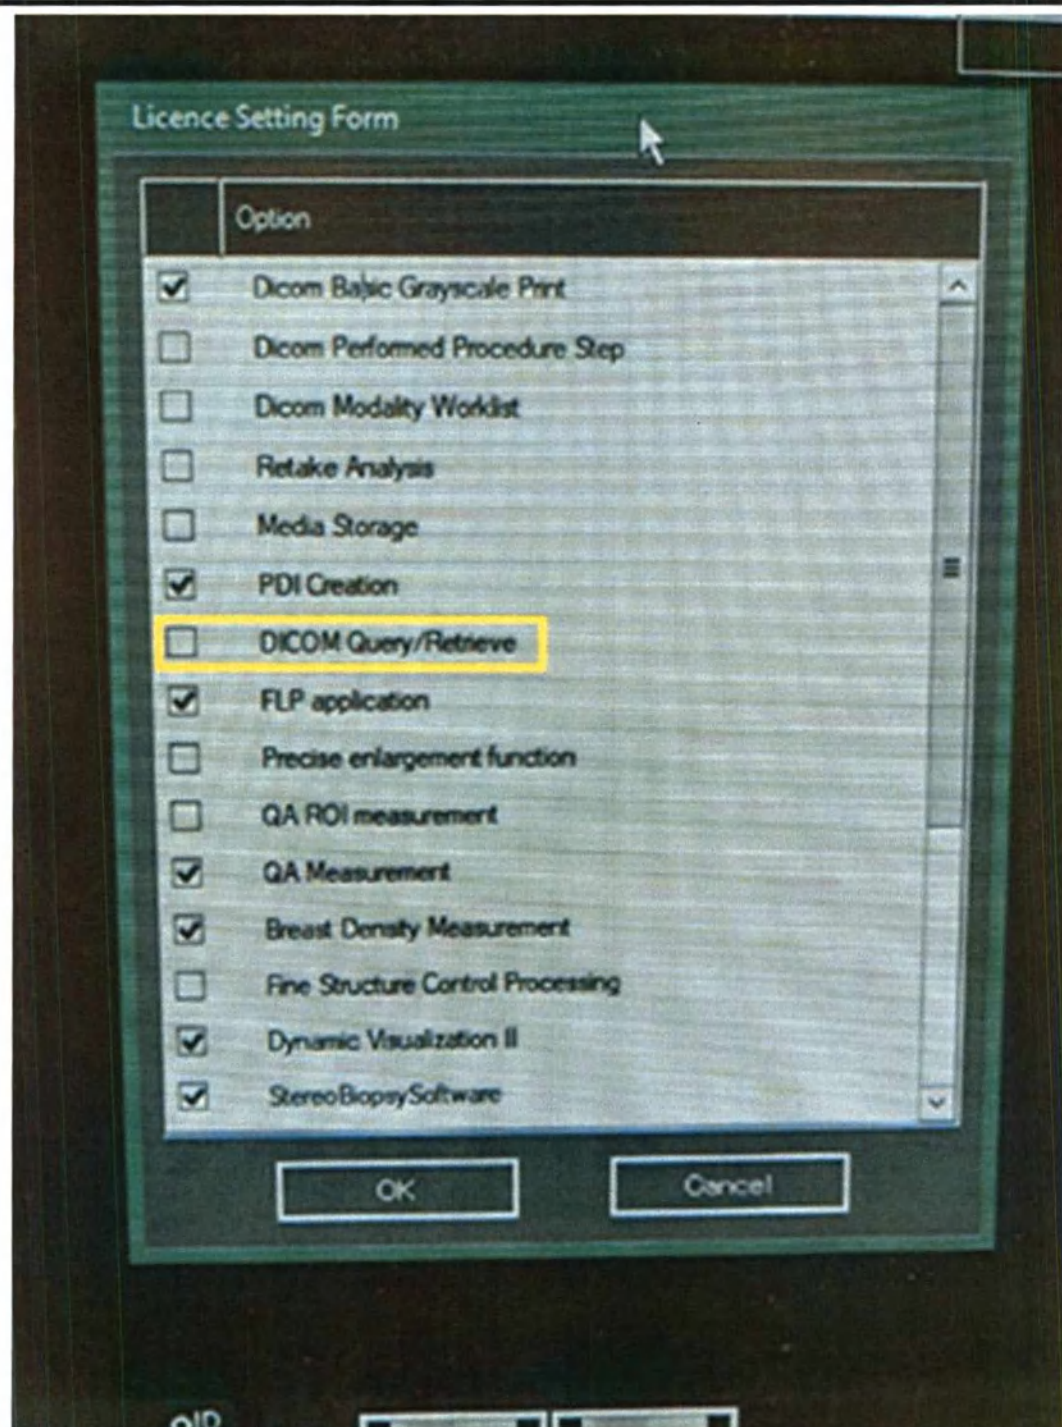


59. Программное обеспечение для анализа изображений для повторного исследования.

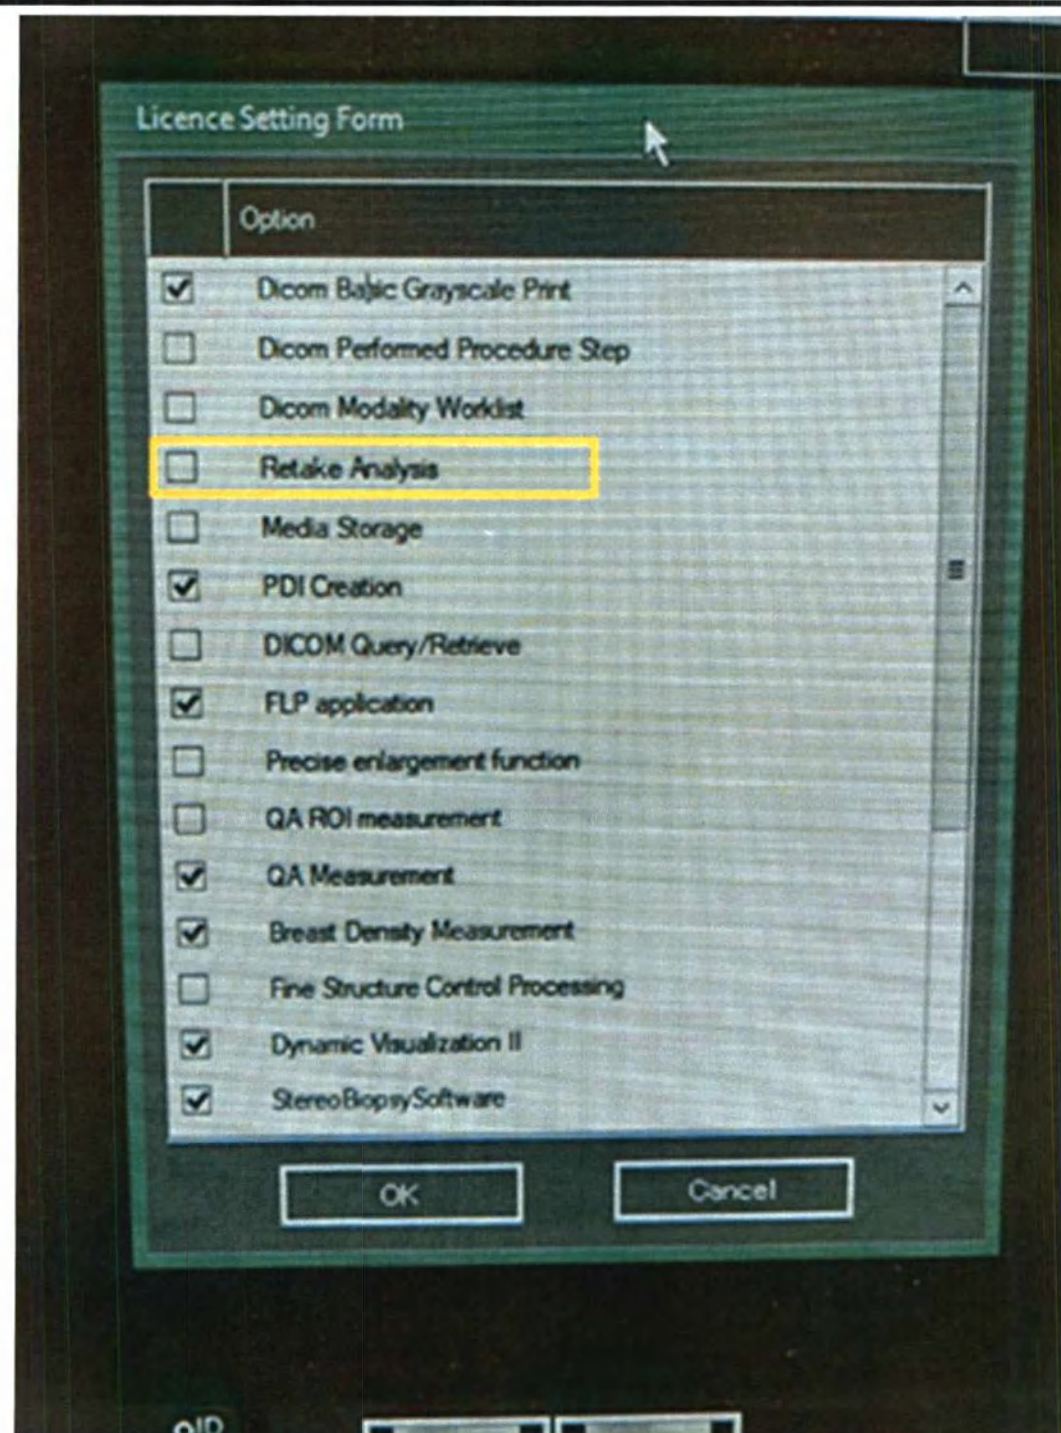


60. Программное обеспечение для измерения параметров изображения в зоне интереса.

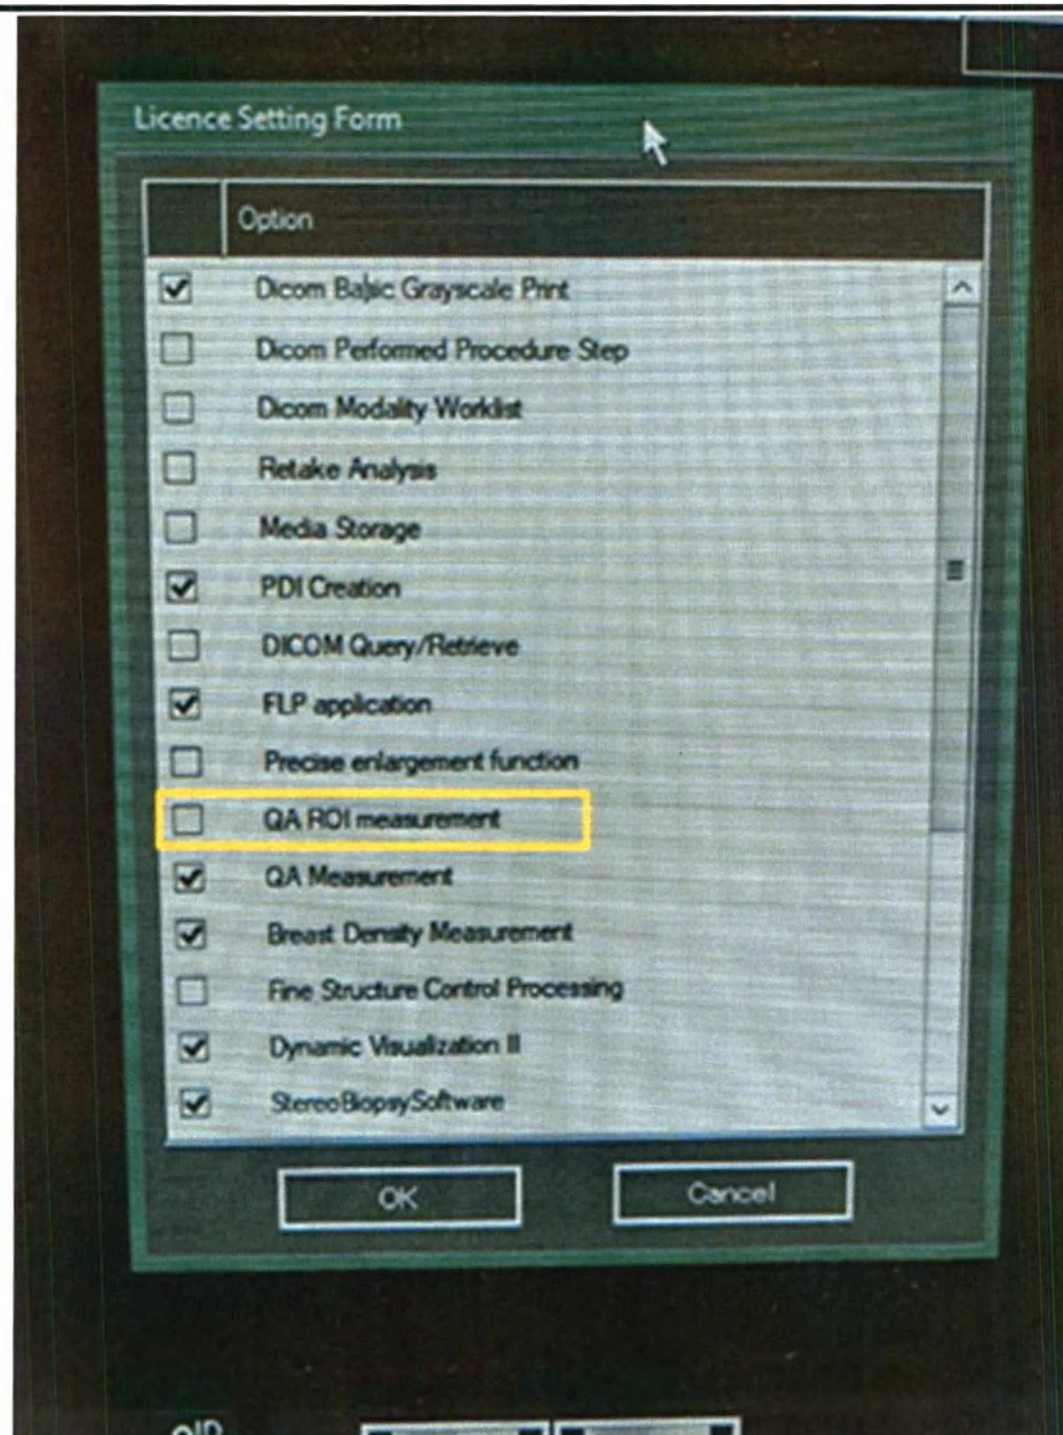


61. Программное обеспечение для измерения длин отрезков на изображении.

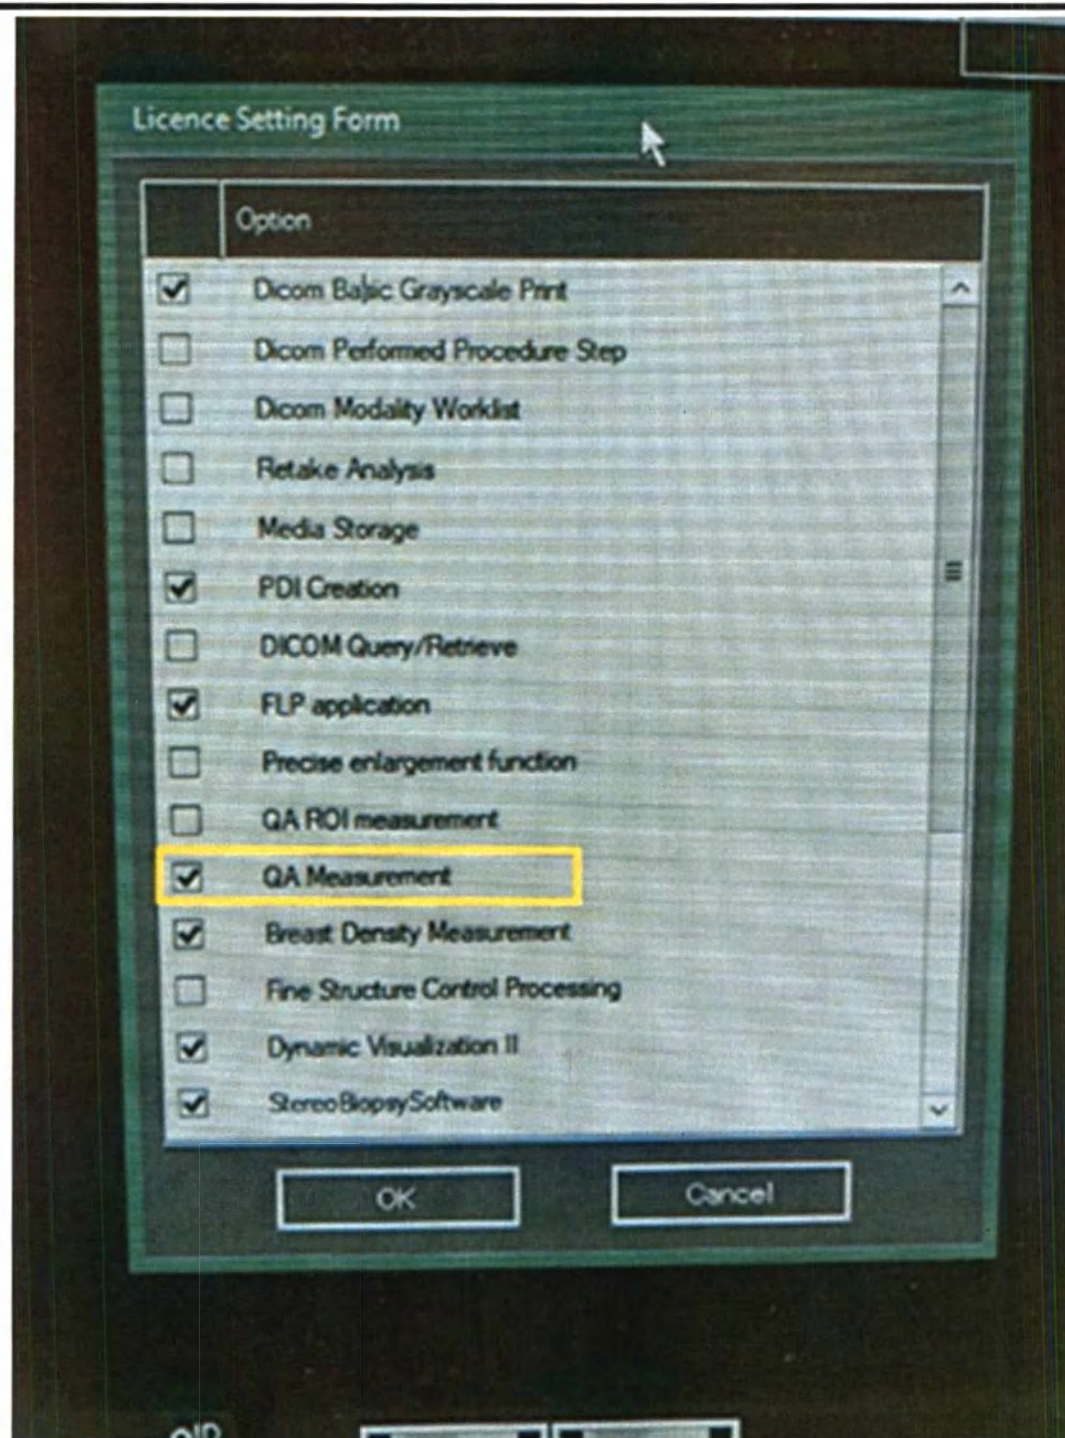


62. Программное обеспечение для обратной реконструкции 2D изображений из 3D.

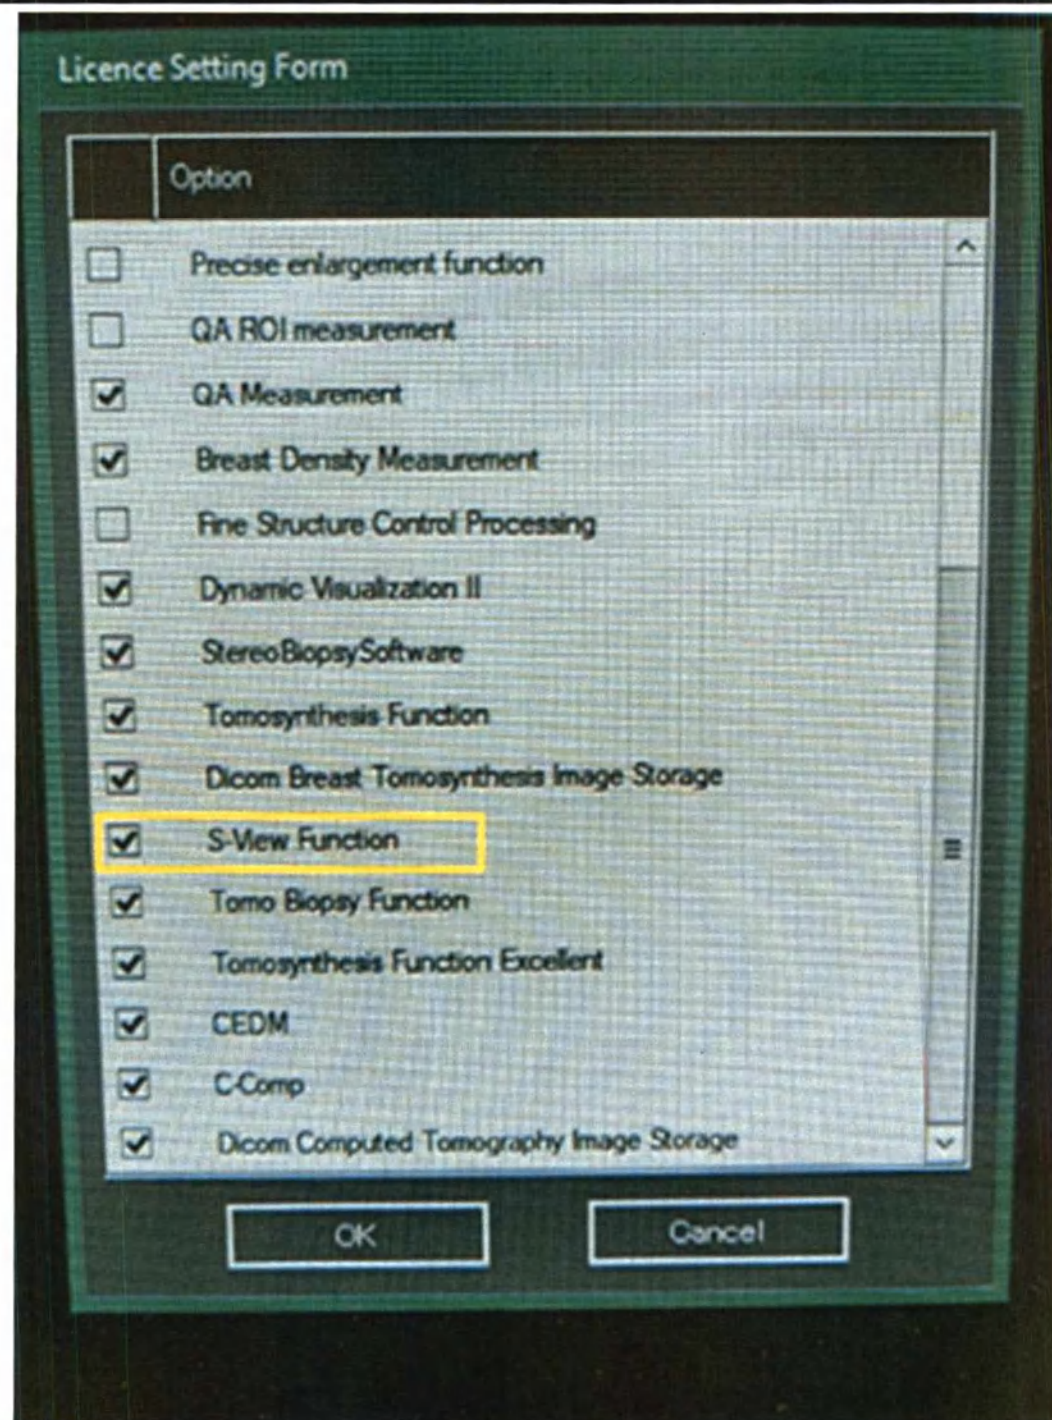


63. Программное обеспечение функции комфортной компрессии.

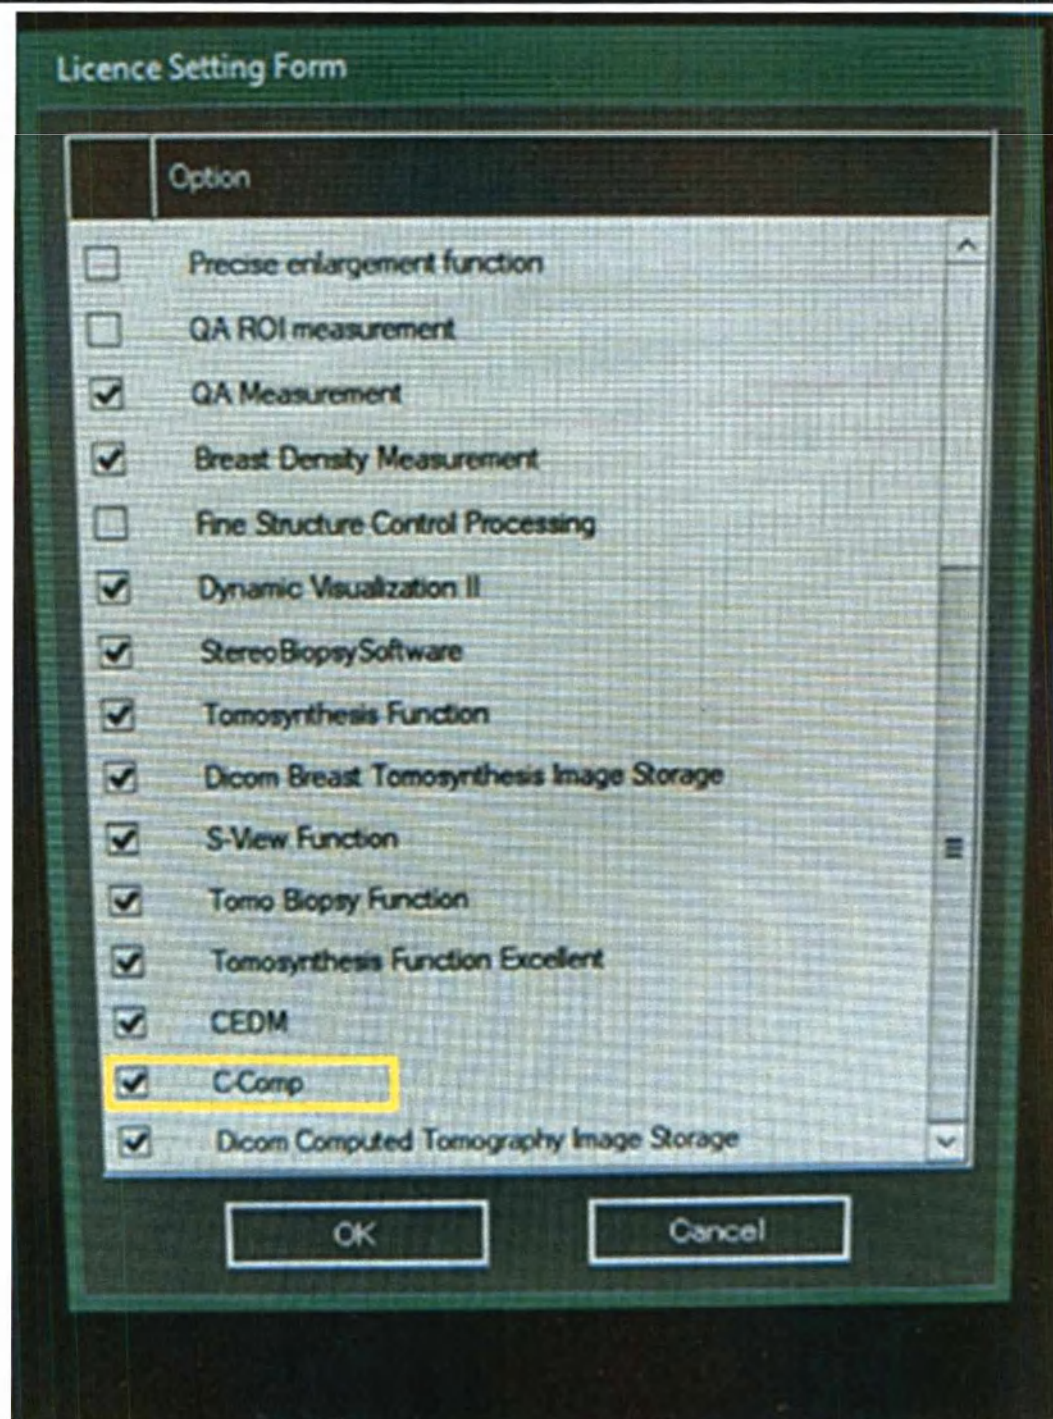


64. Программное обеспечение функции определения плотности молочной железы.

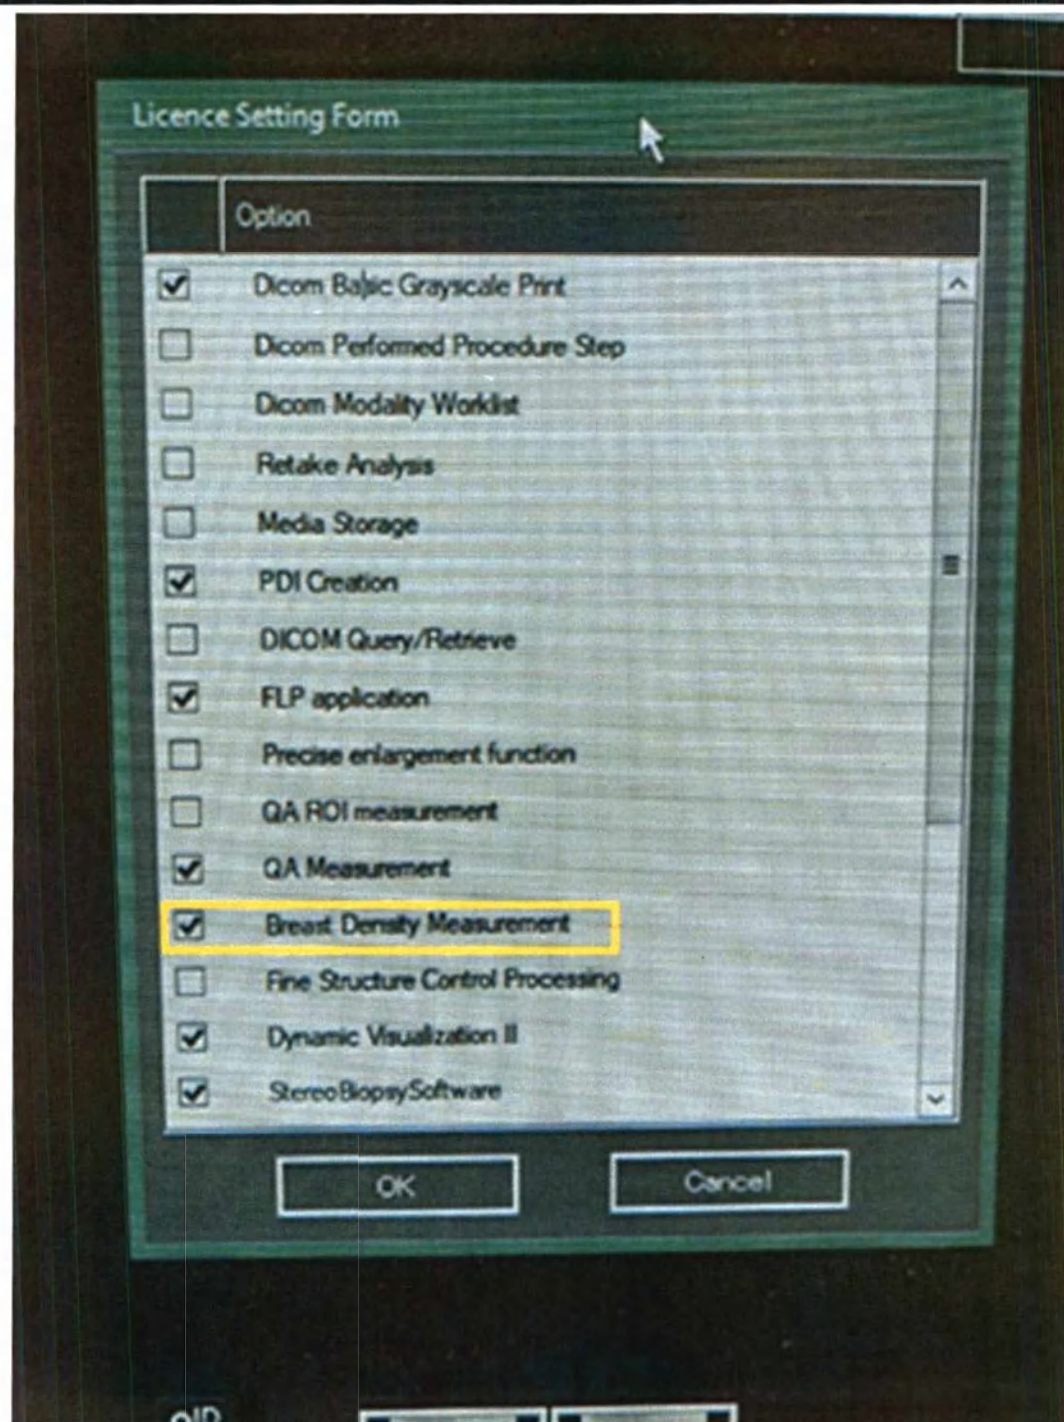


65. Программное обеспечение функции снижения шумов и улучшения резкости изображения.

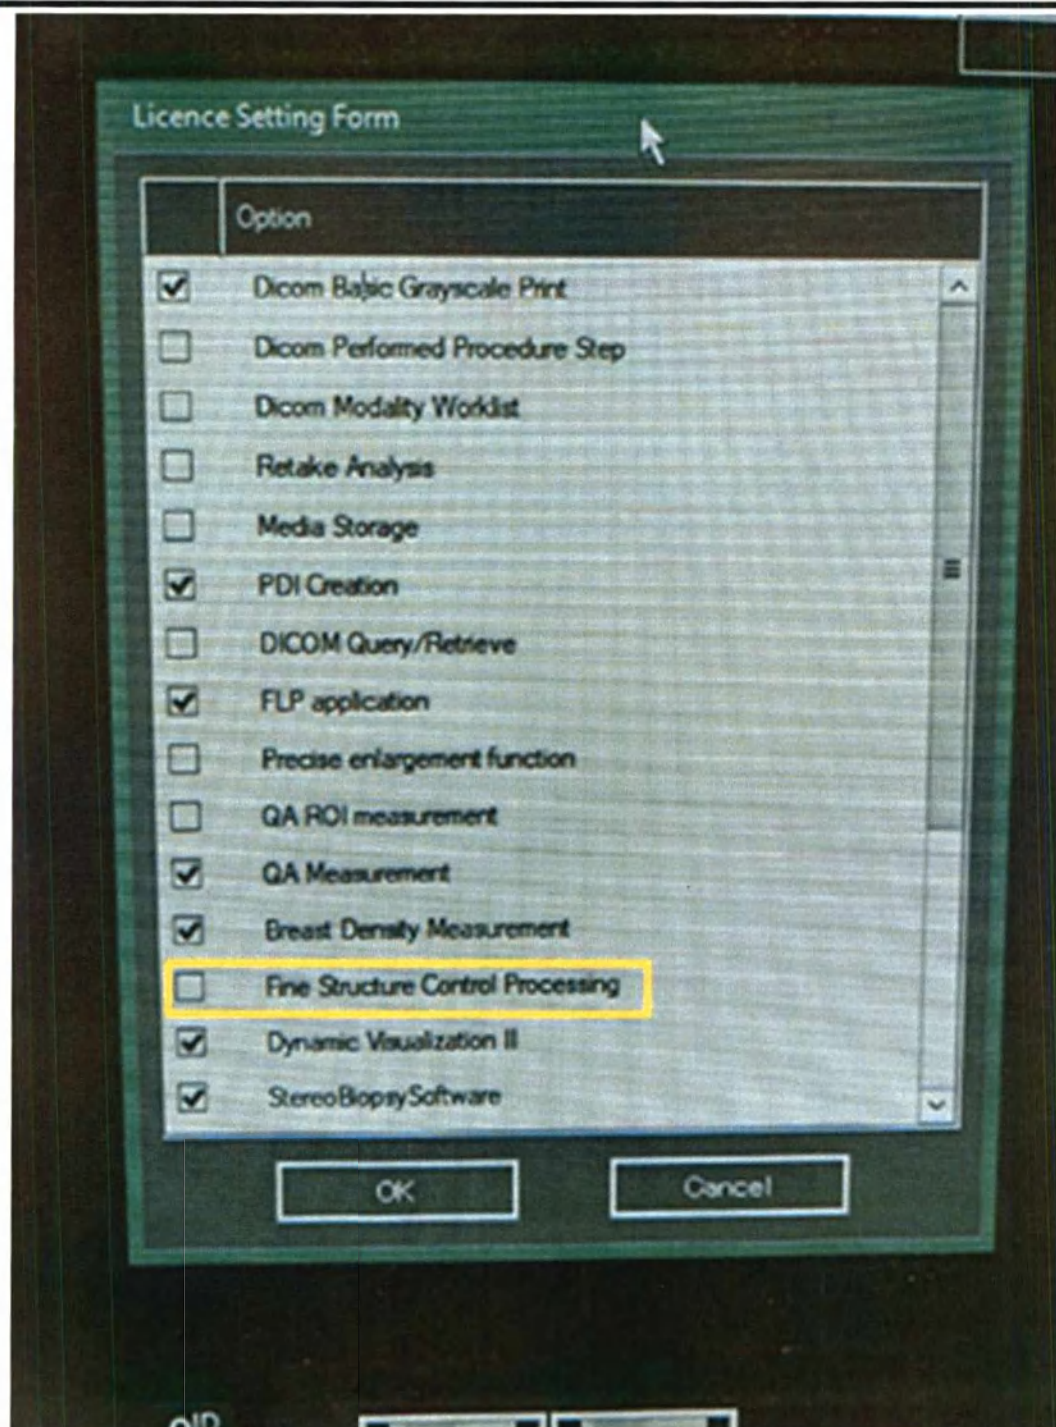


66. Программное обеспечение функции динамической визуализации.

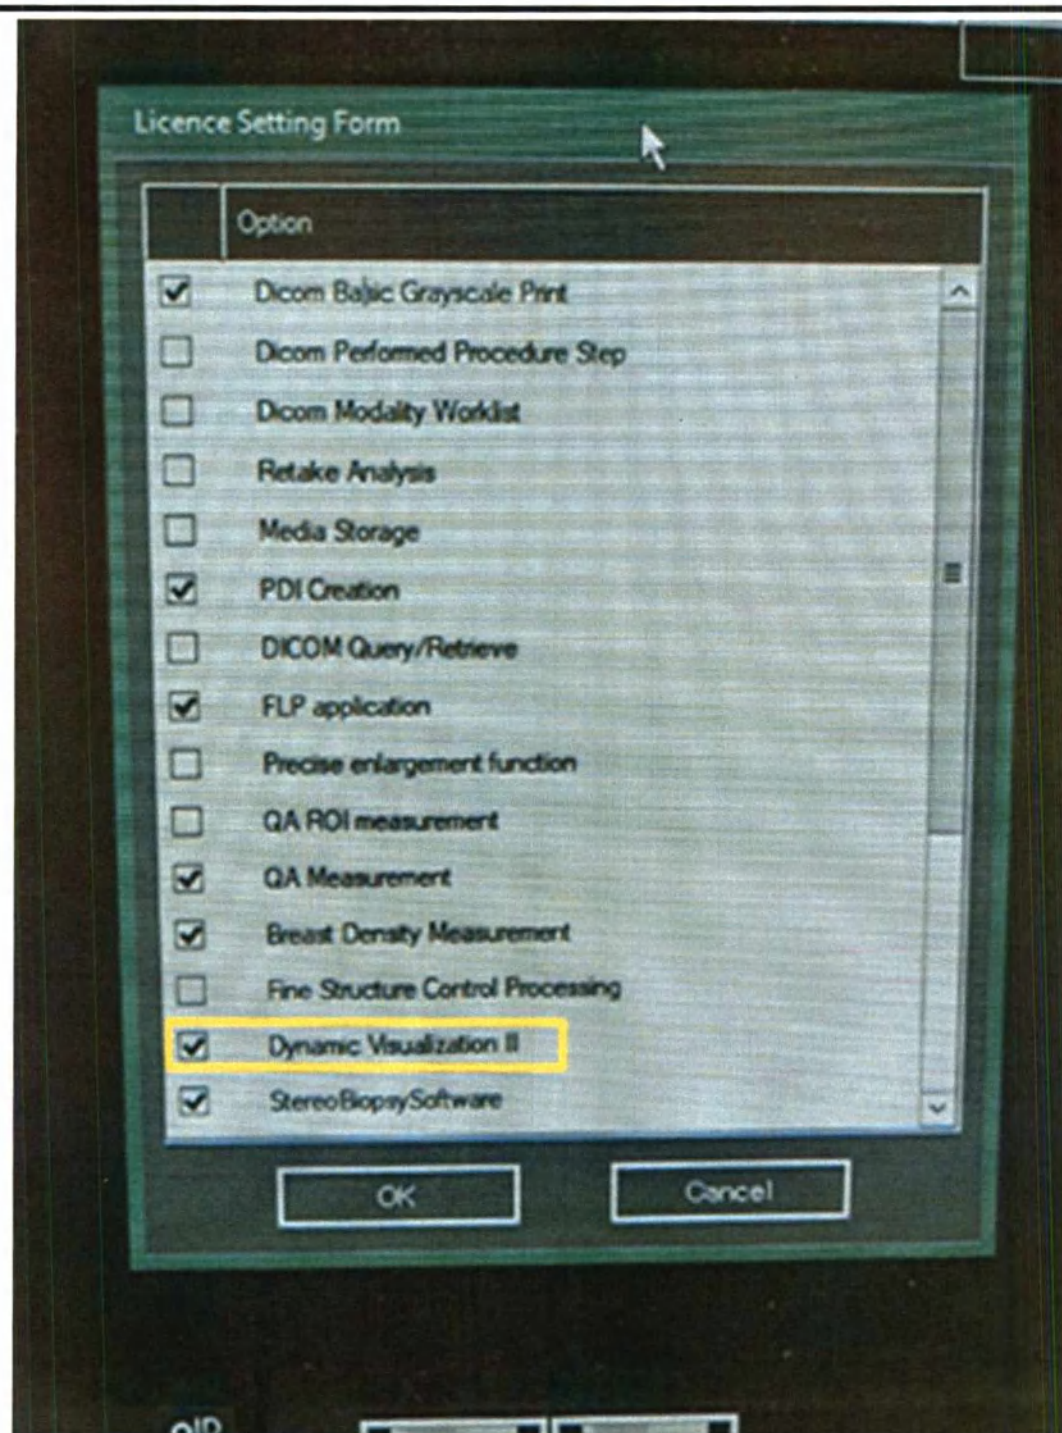


67. Программное обеспечение функции печати нескольких изображений на одной плёнке.

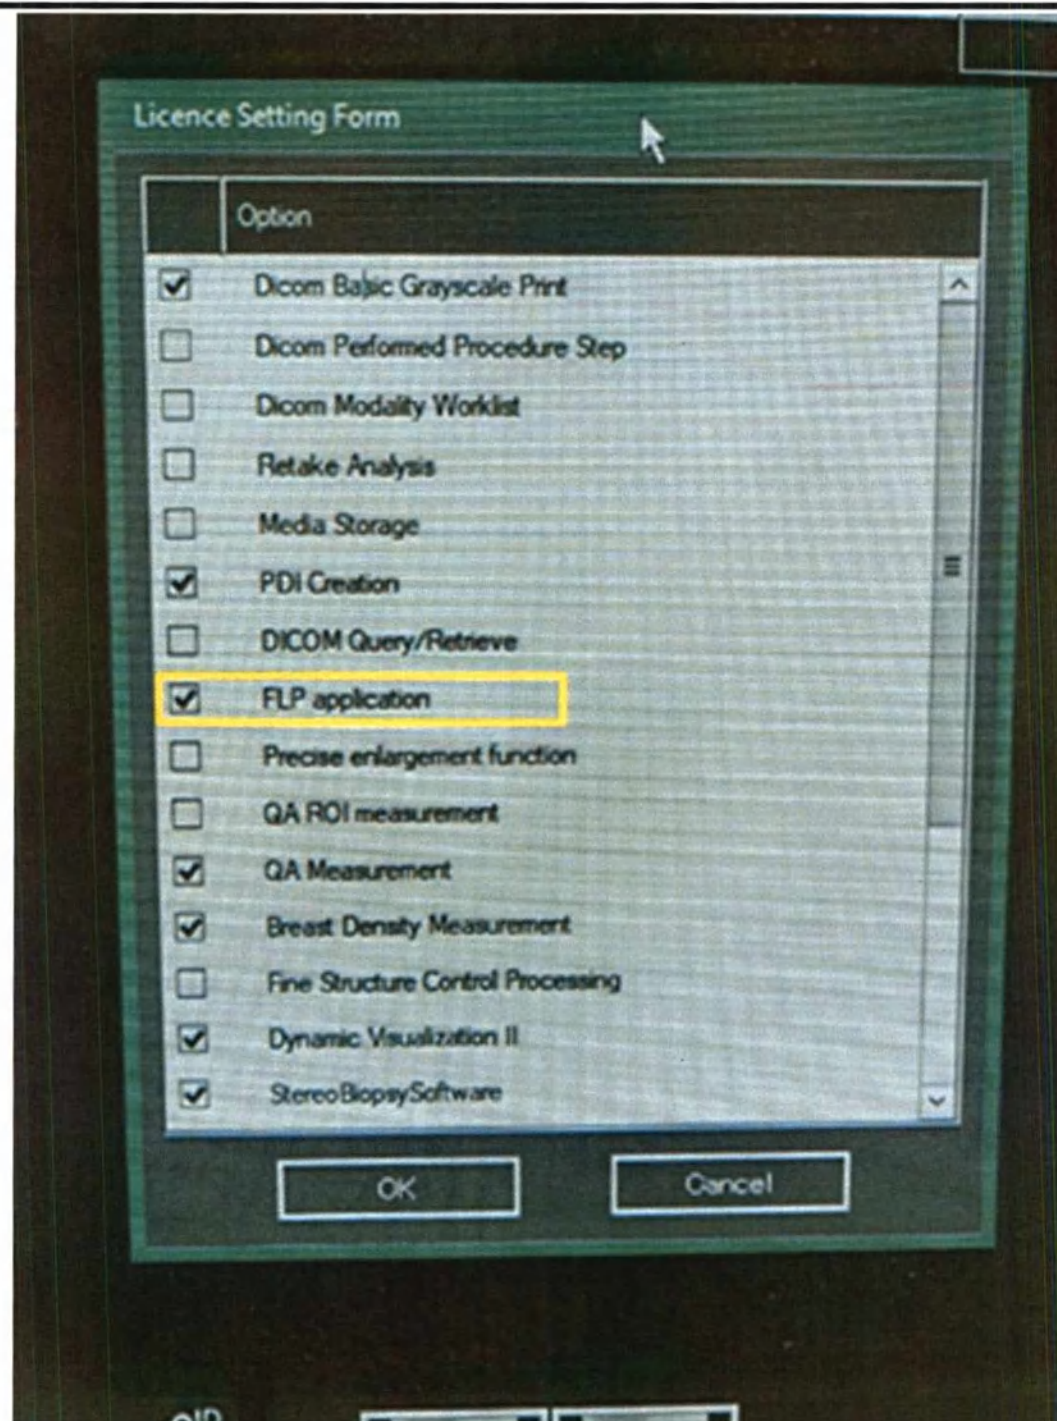


68. Программное обеспечение функции передачи сведений о выполненных исследованиях в системы HIS и RIS по DICOM-протоколу.

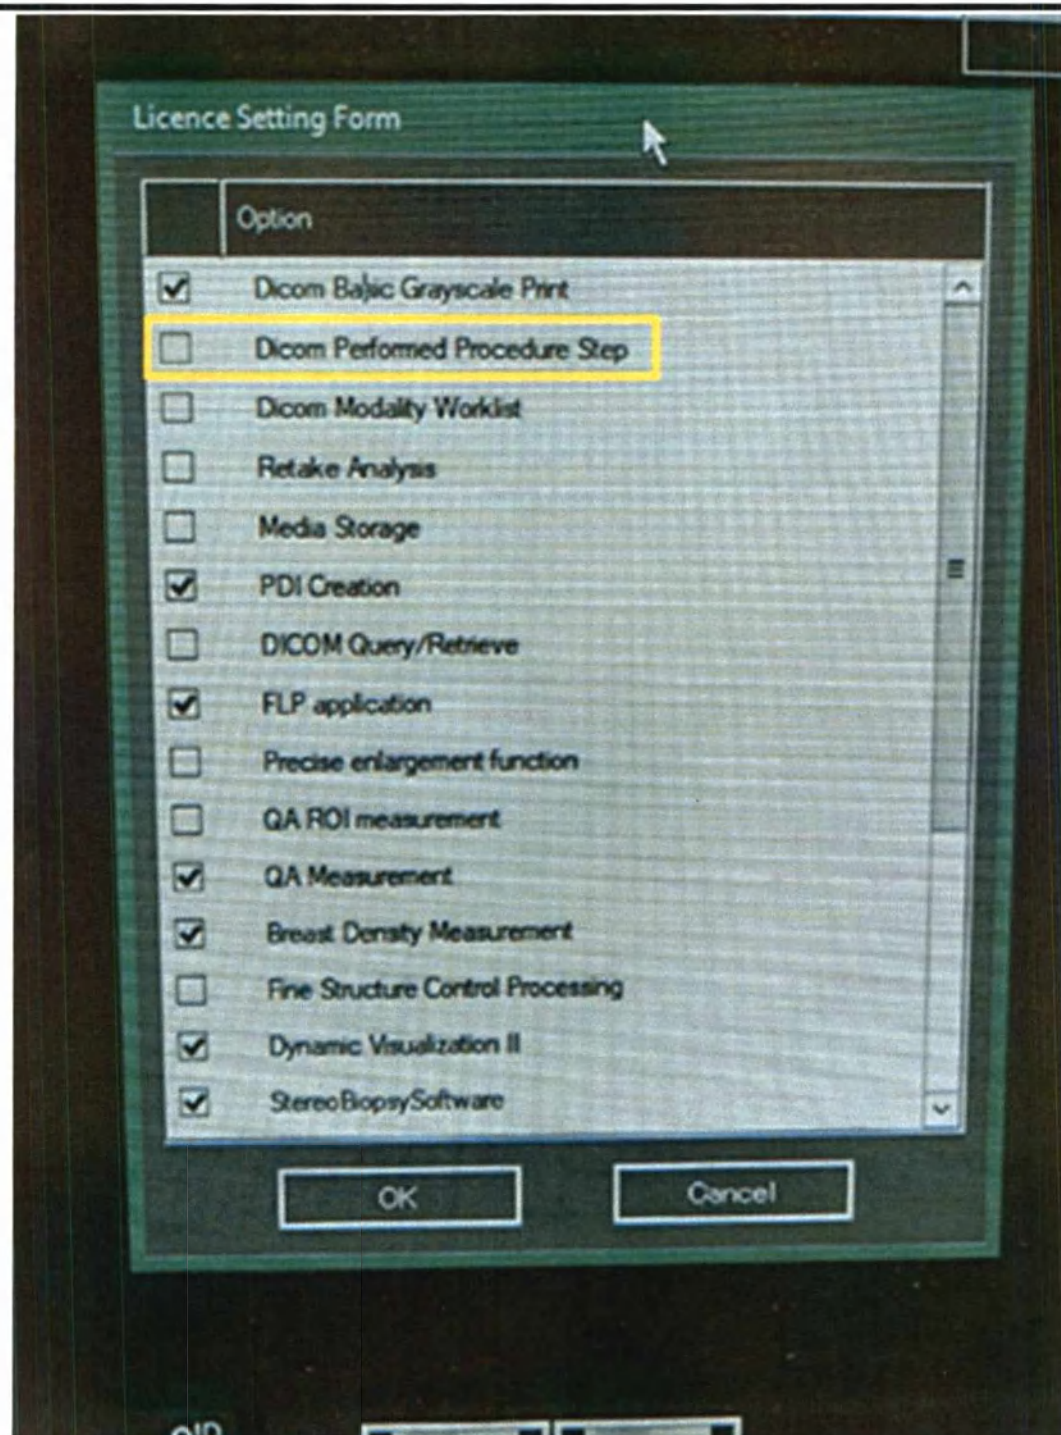


69. Плата для поворота трубки во время исследования.

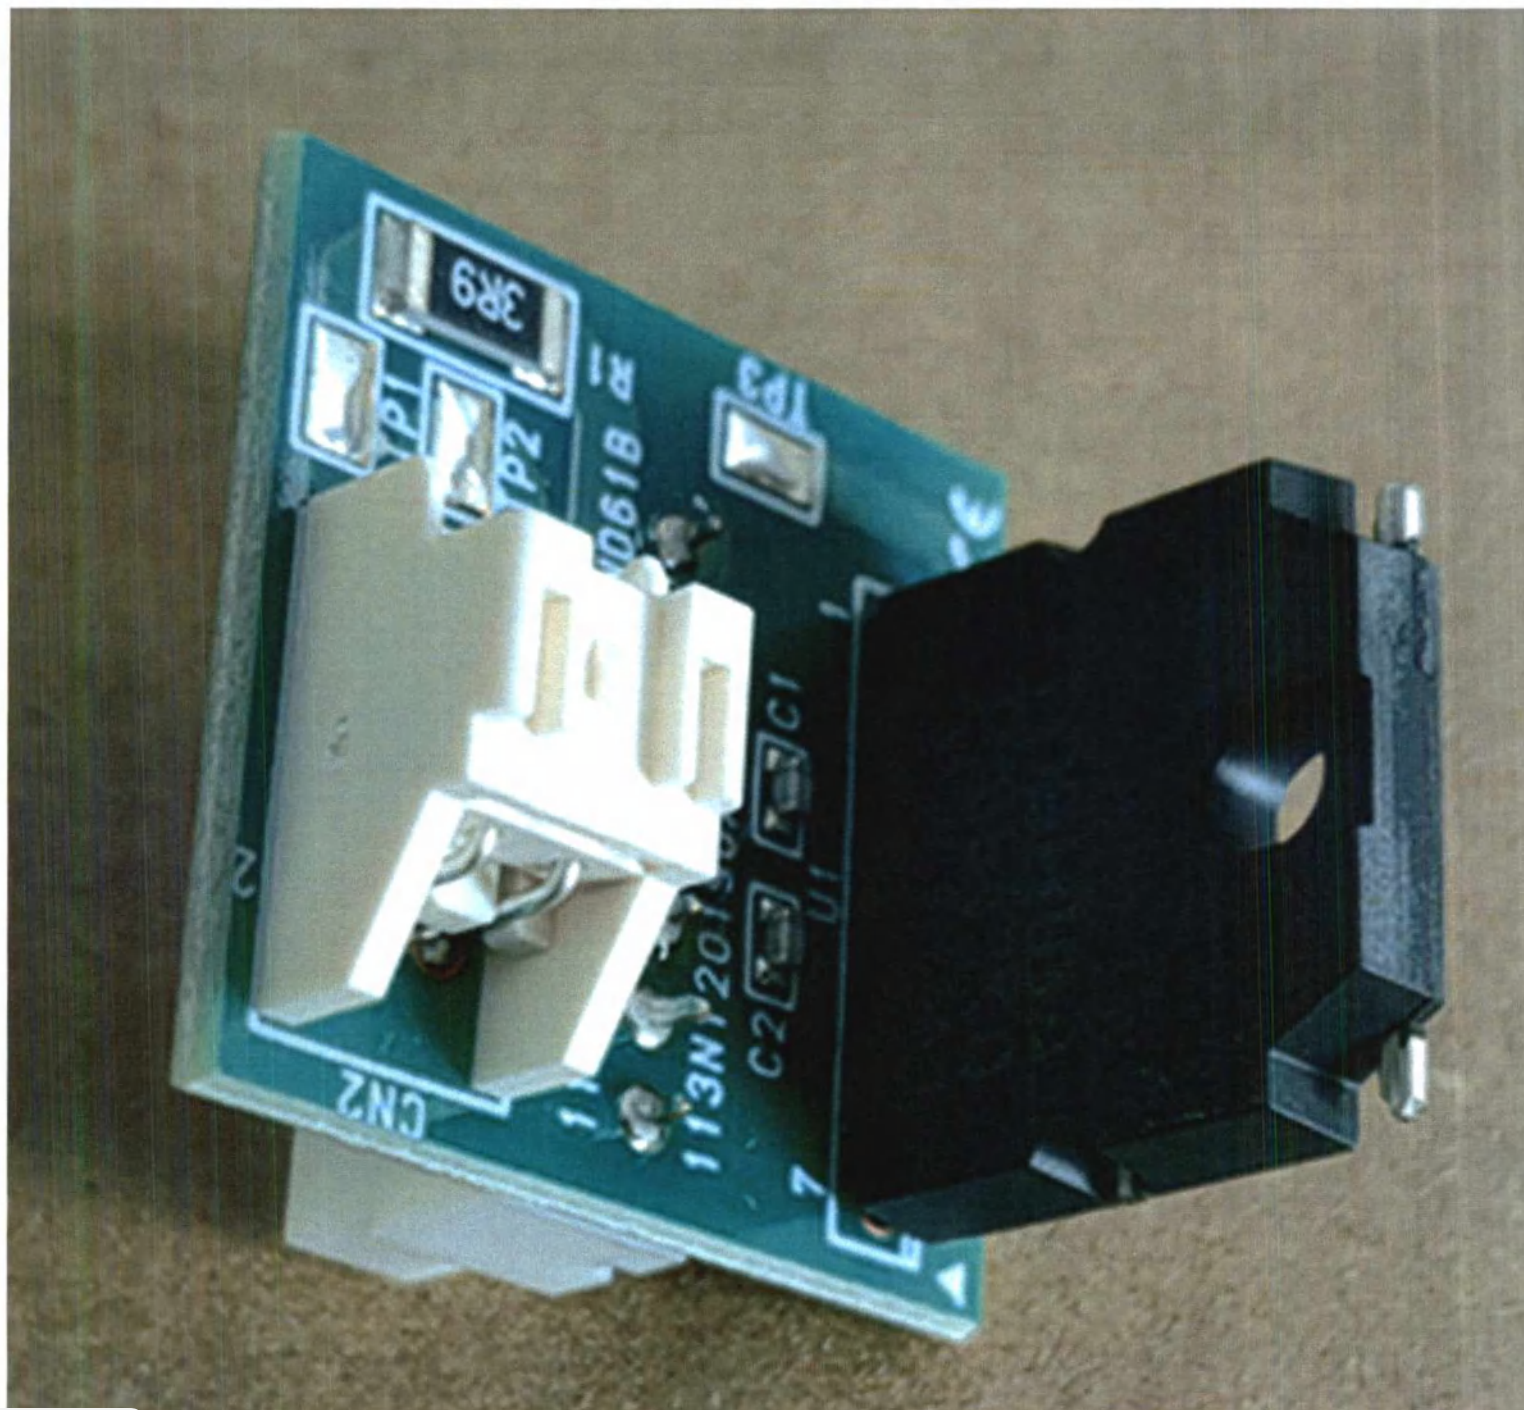

69. Плата для поворота трубки во время исследования.

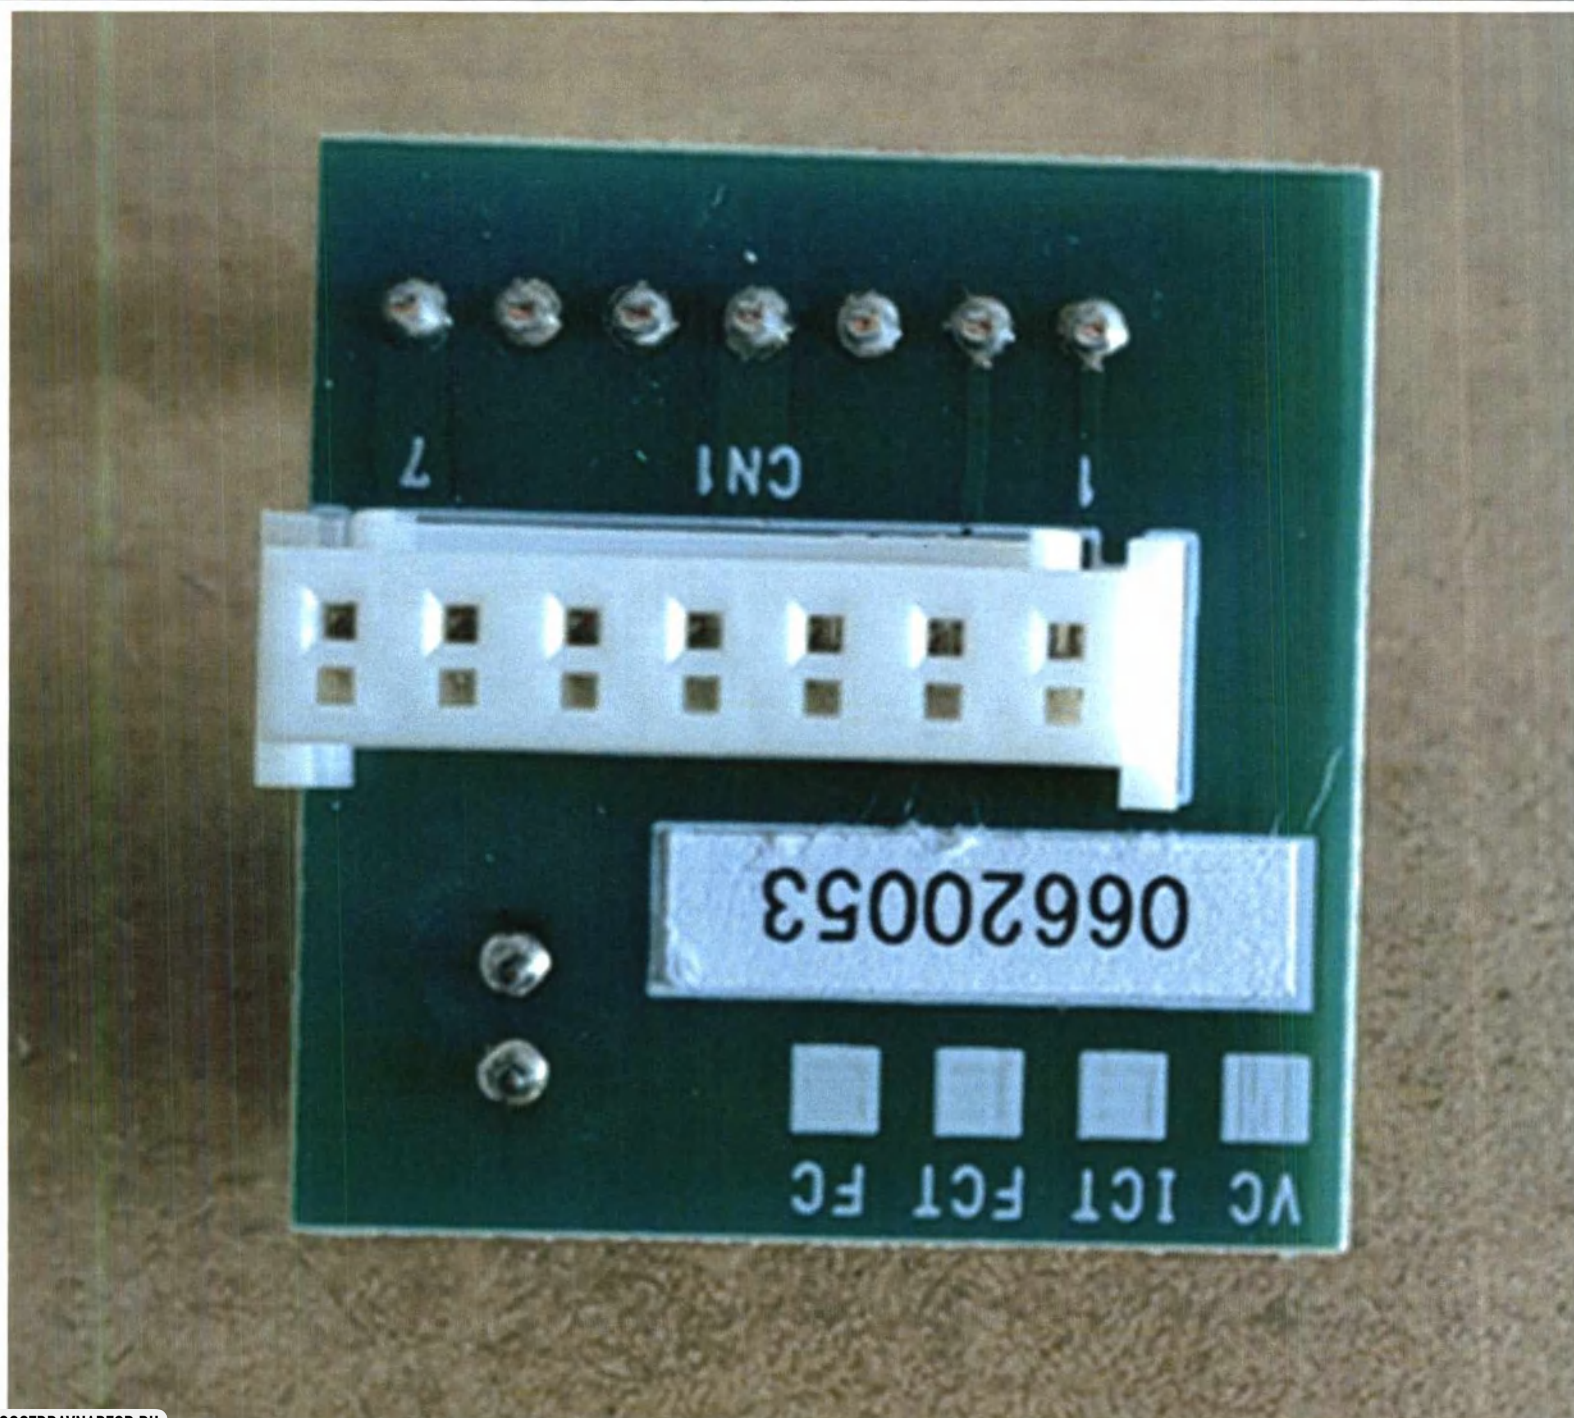


70. Устройство биопсийное

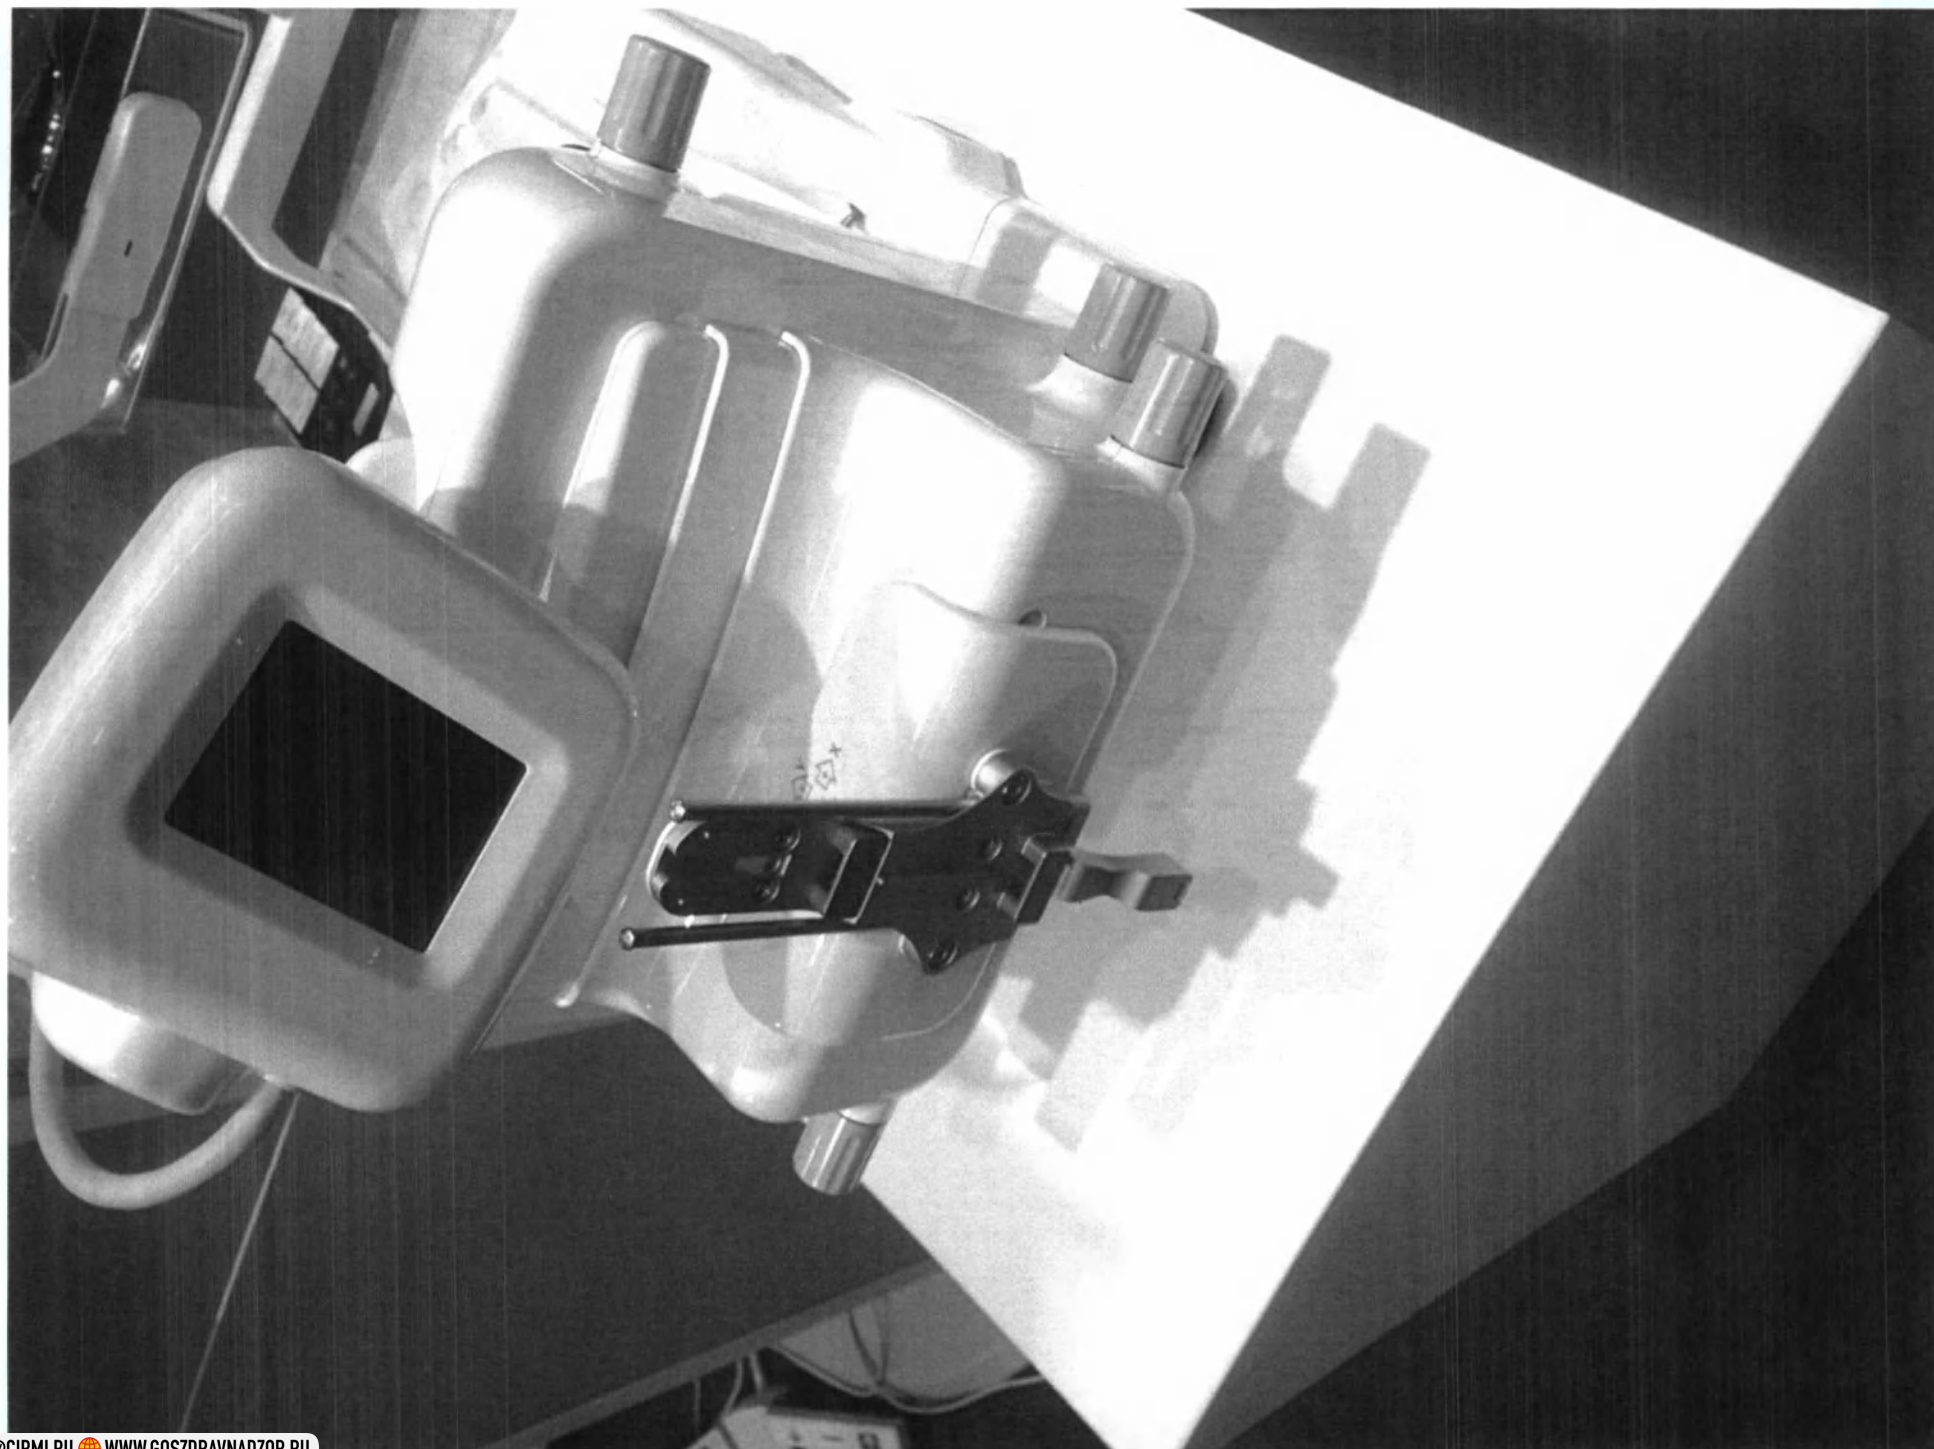




- позиционер;

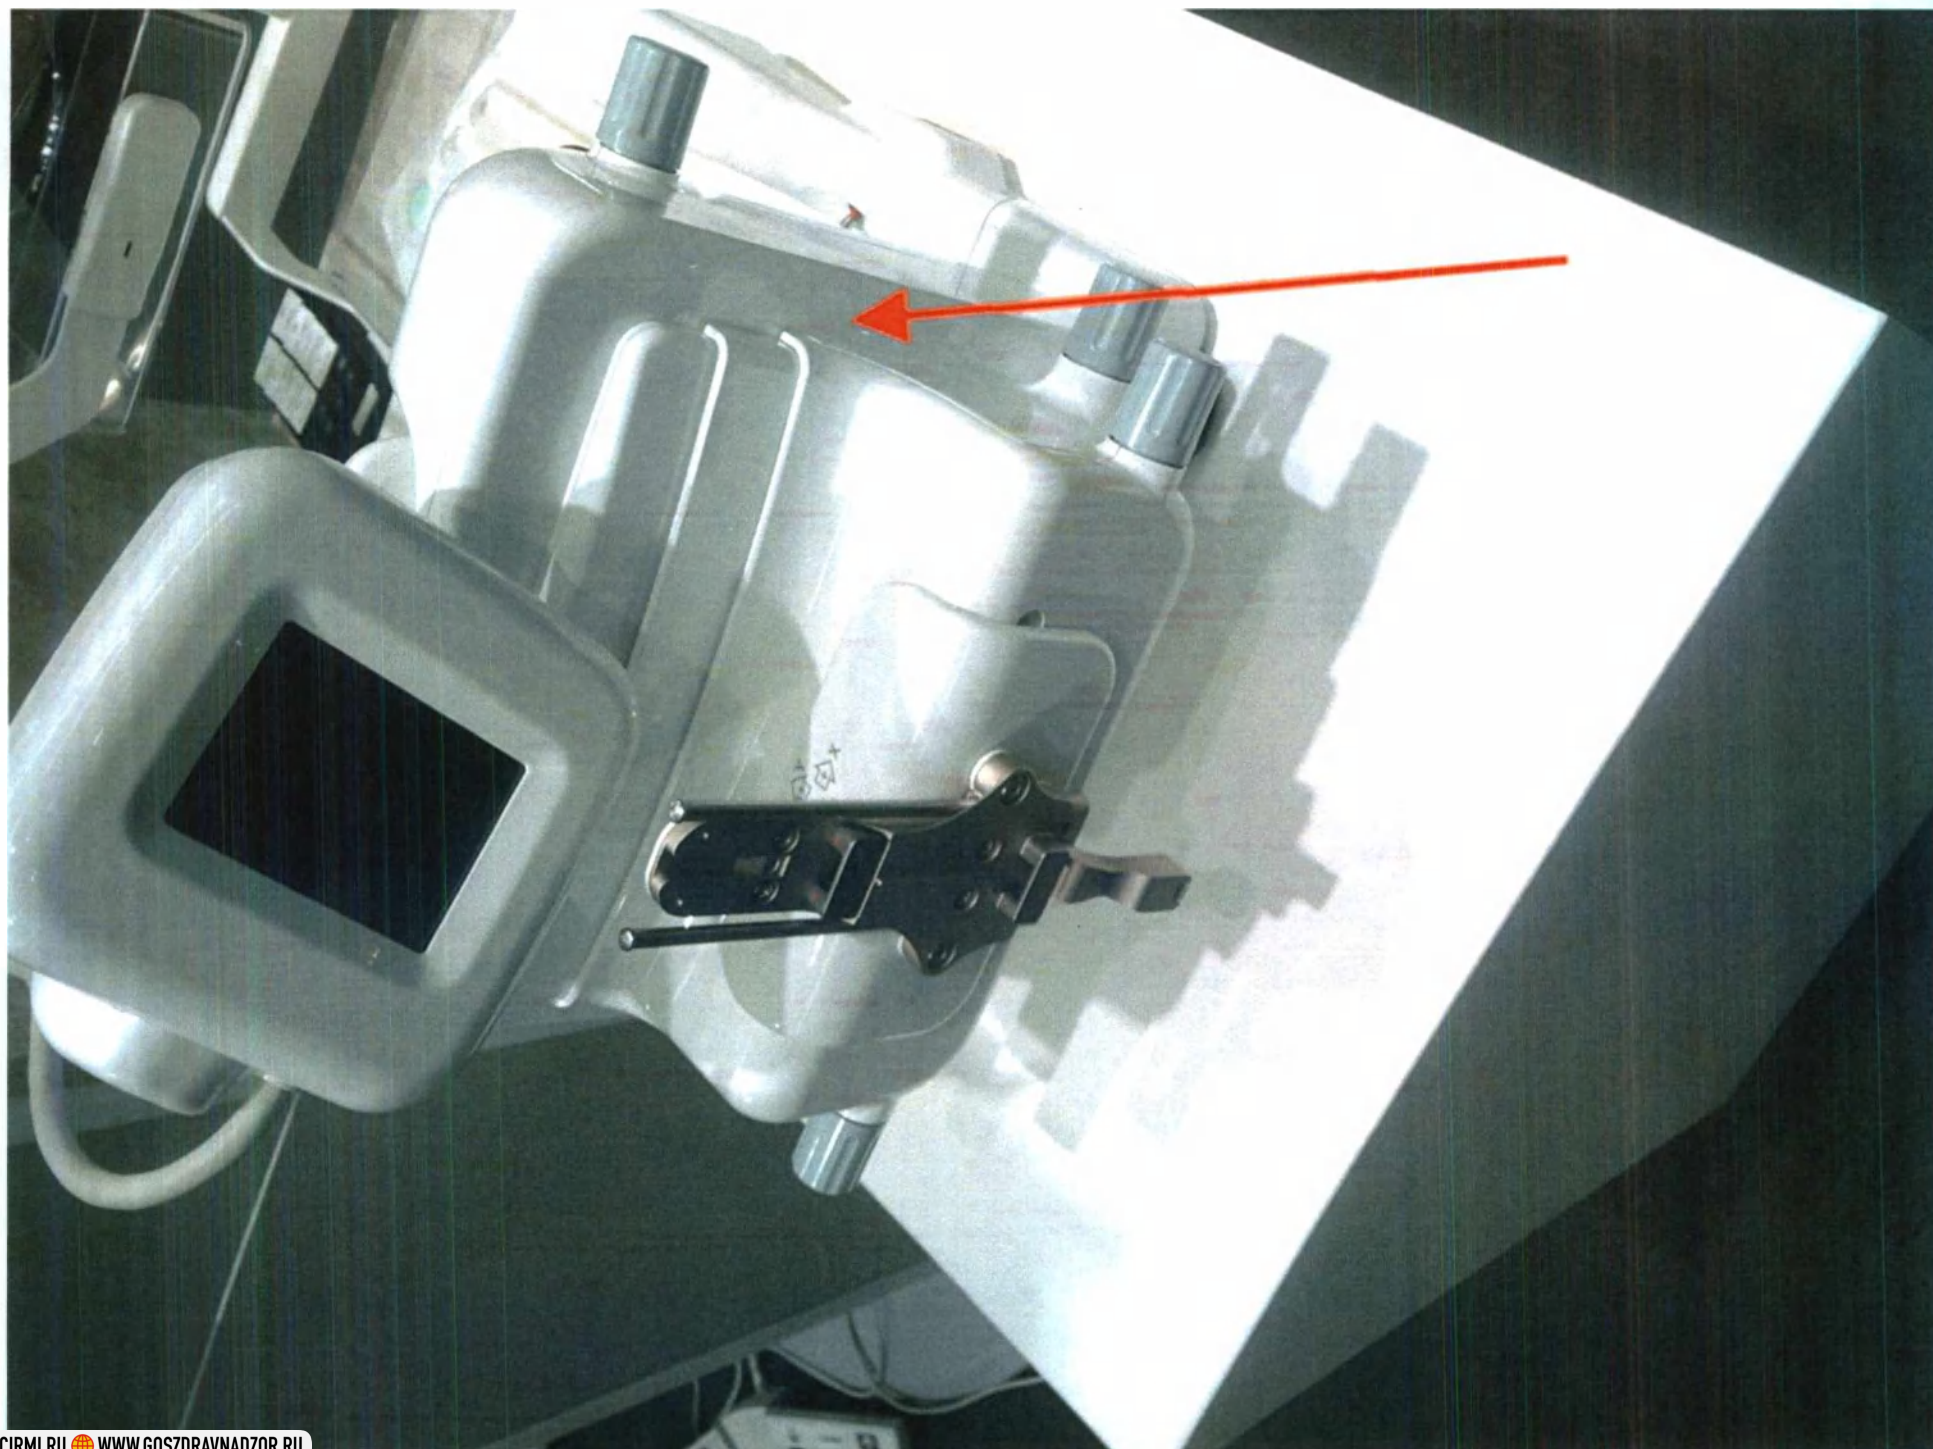



- панель управления;

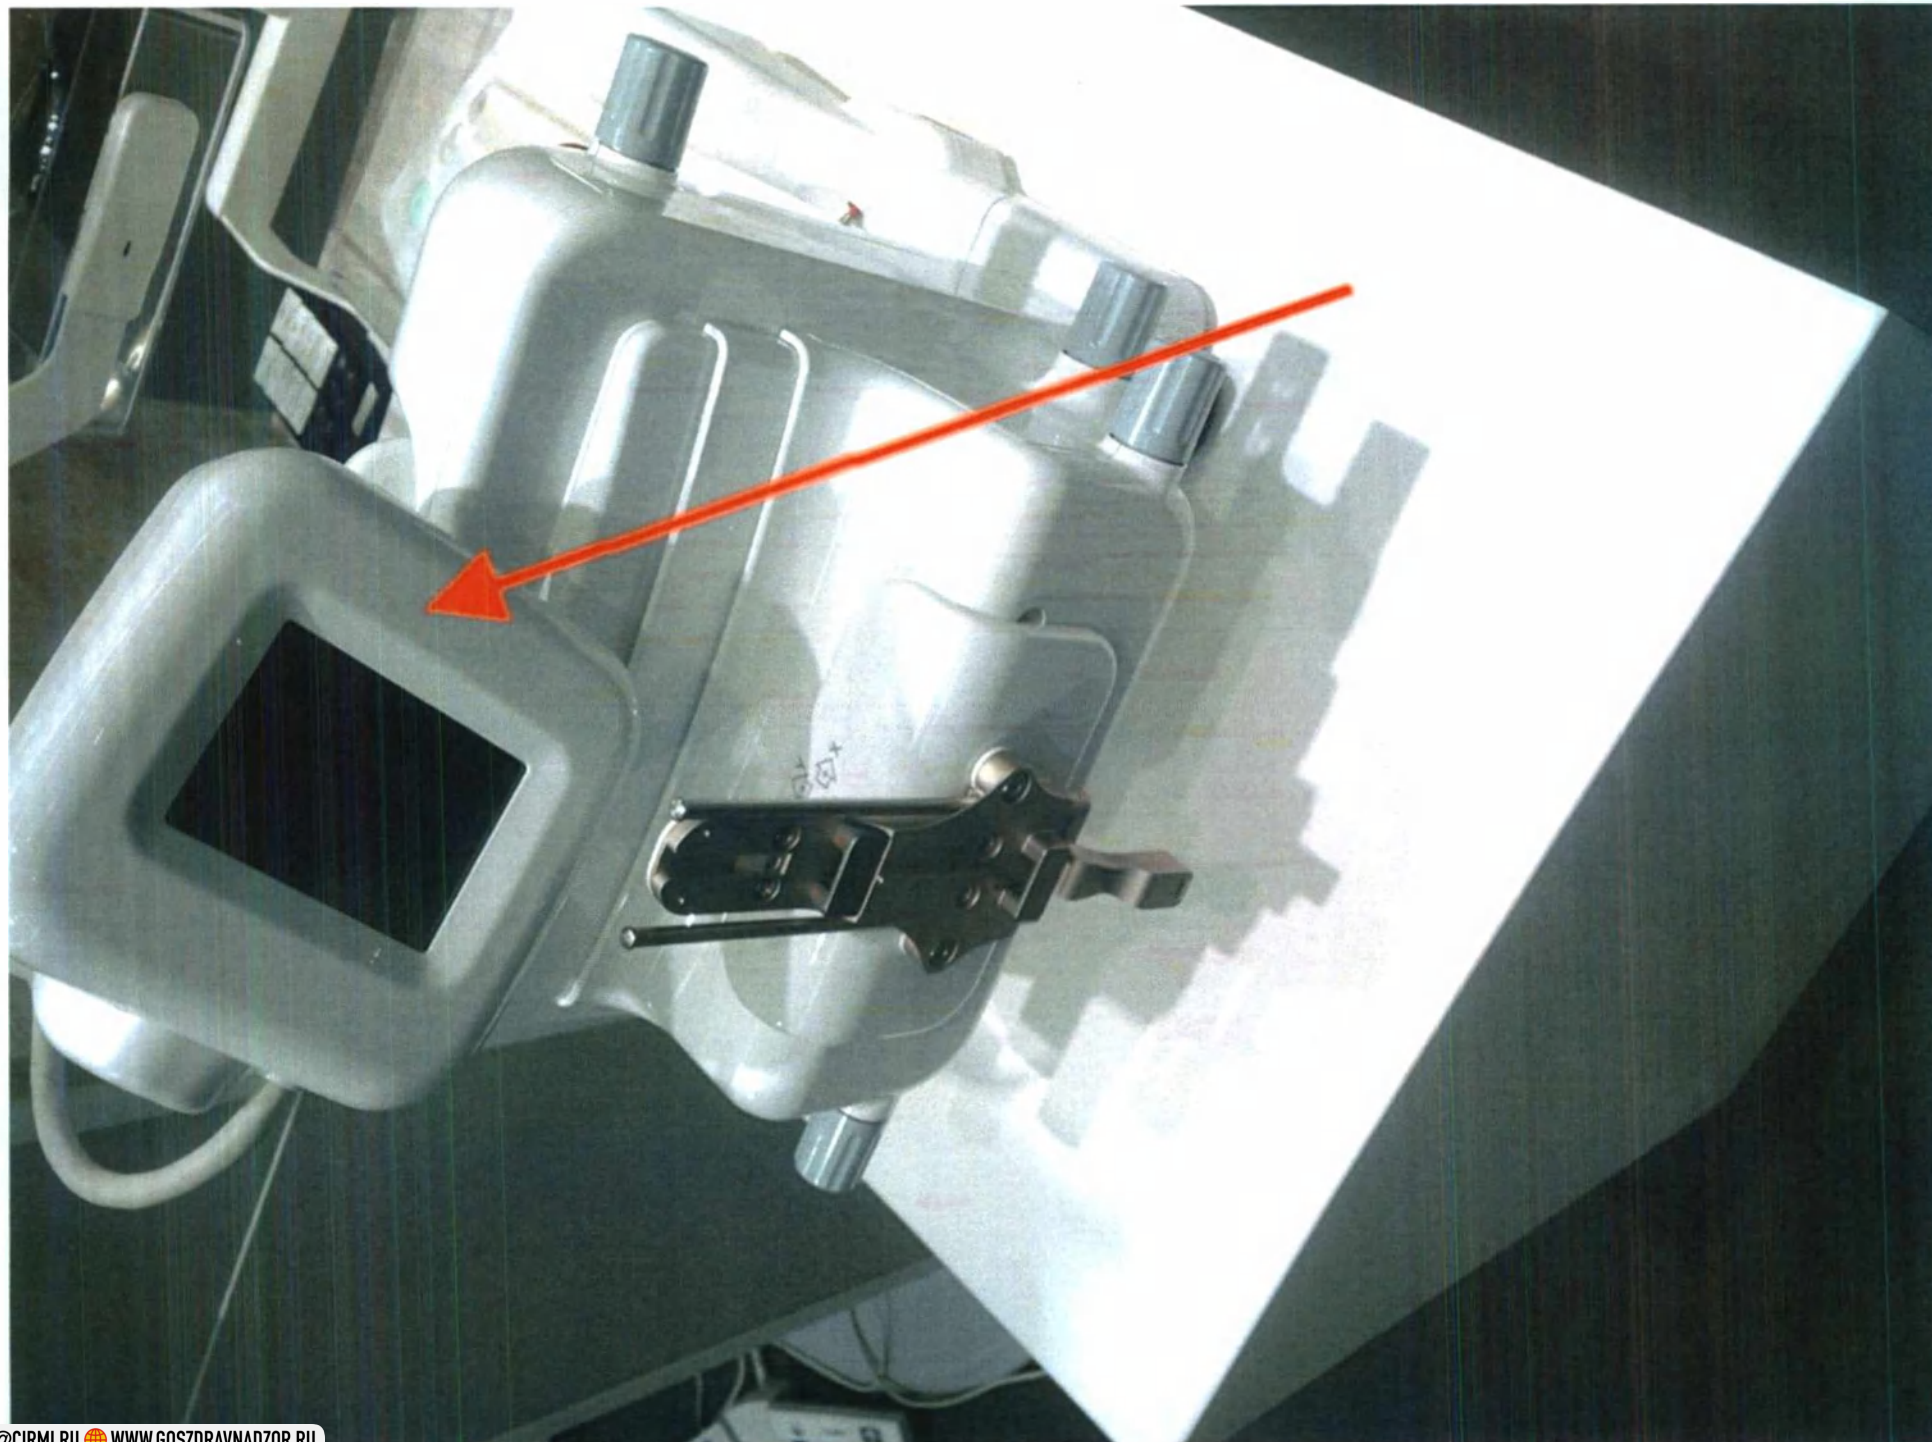


- пластина компрессионная для биопсии;




- держатели игл - не более 5 шт.;




- держатели игл - не более 5 шт.;

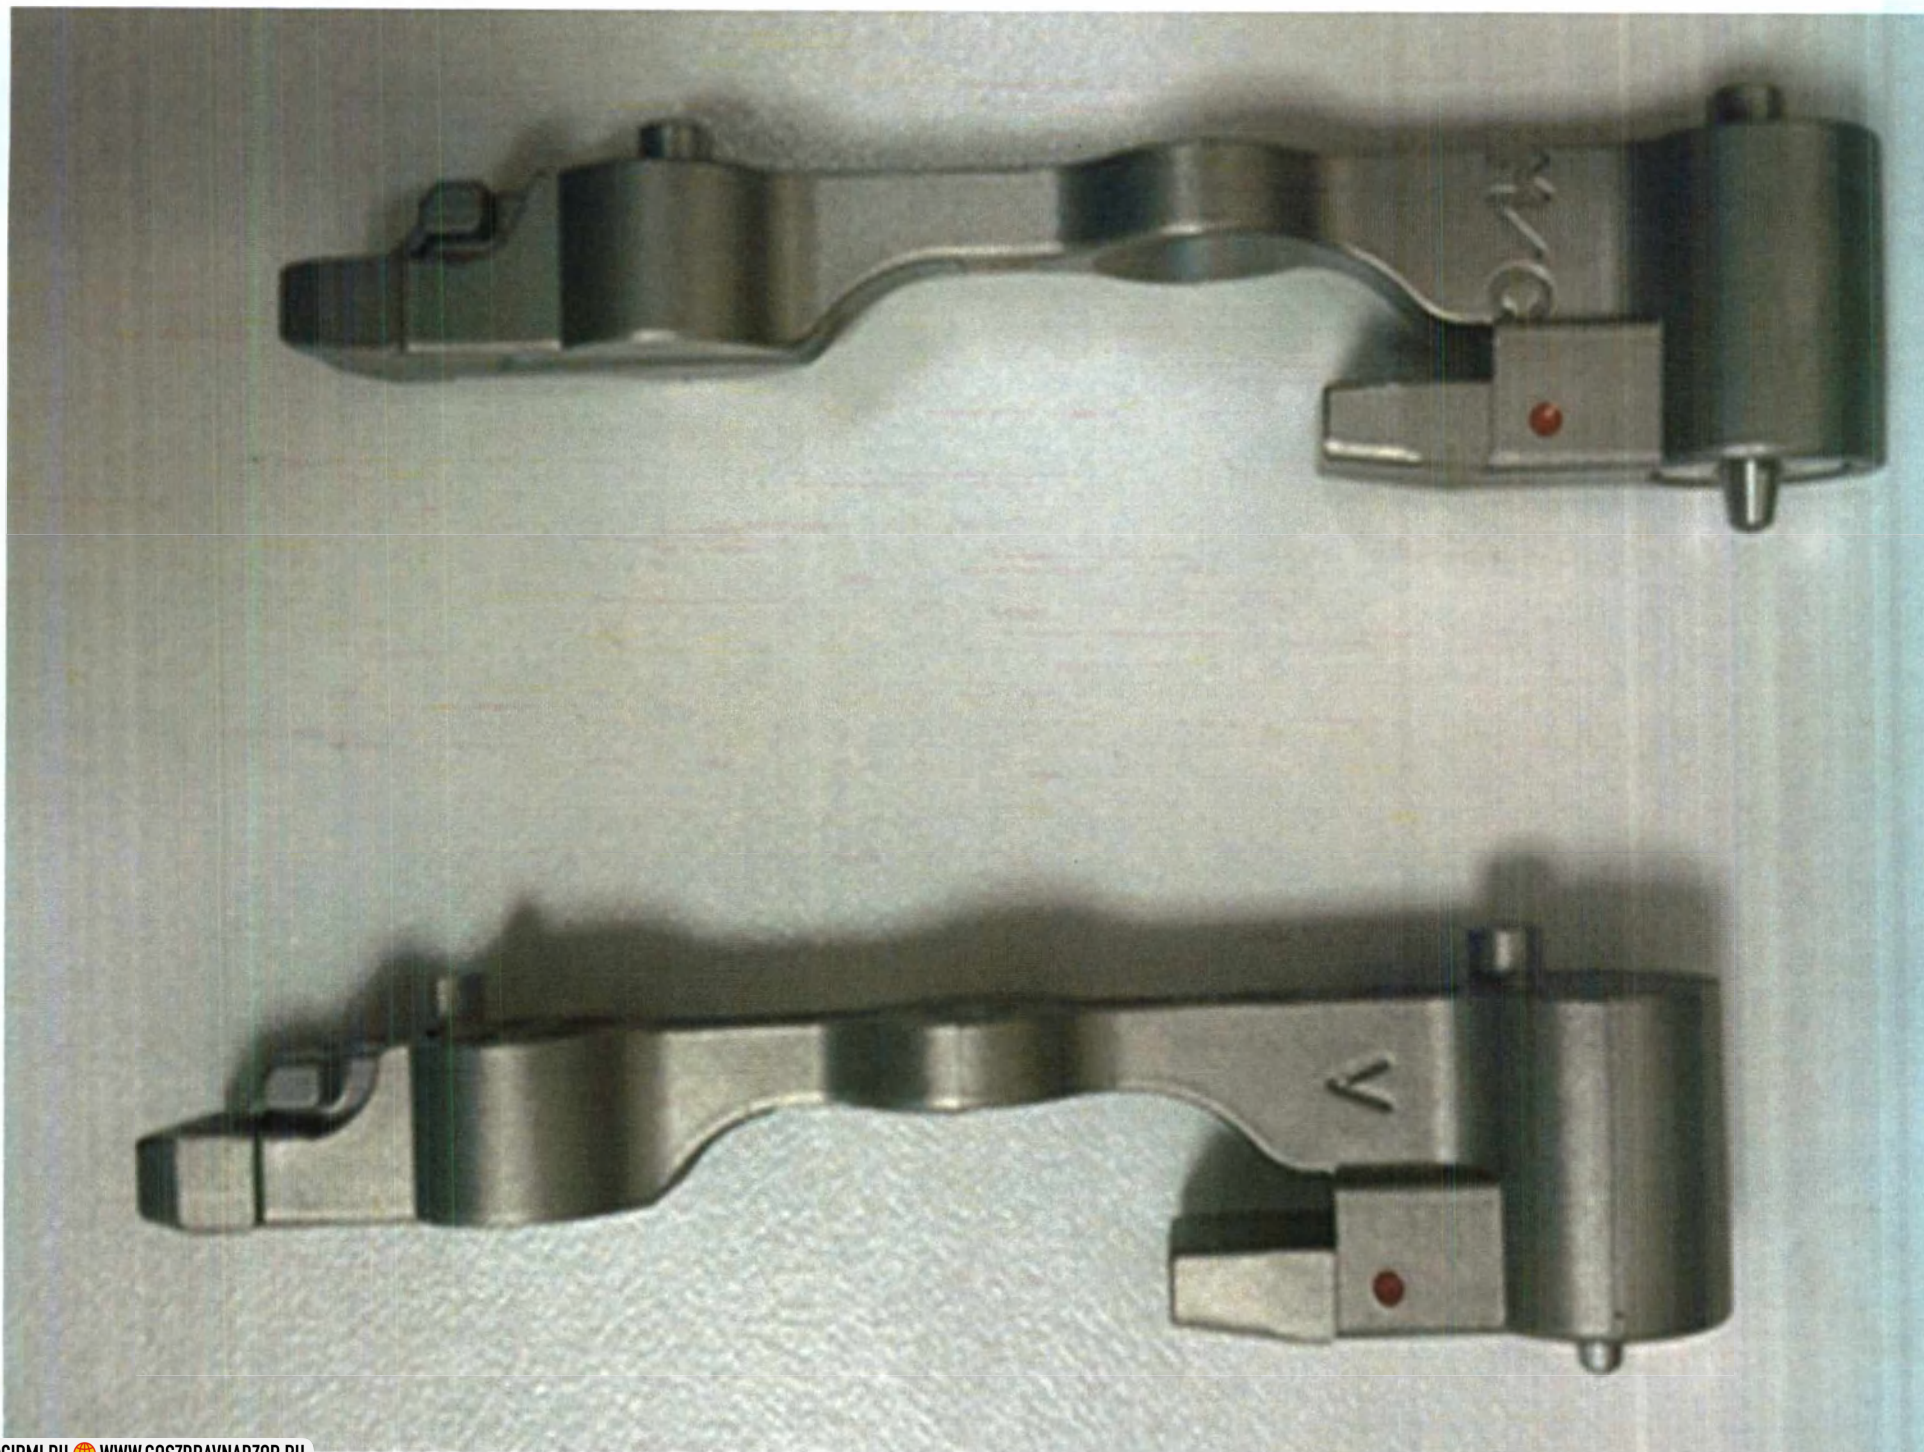


- направляющие для игл - не более 150 шт.;

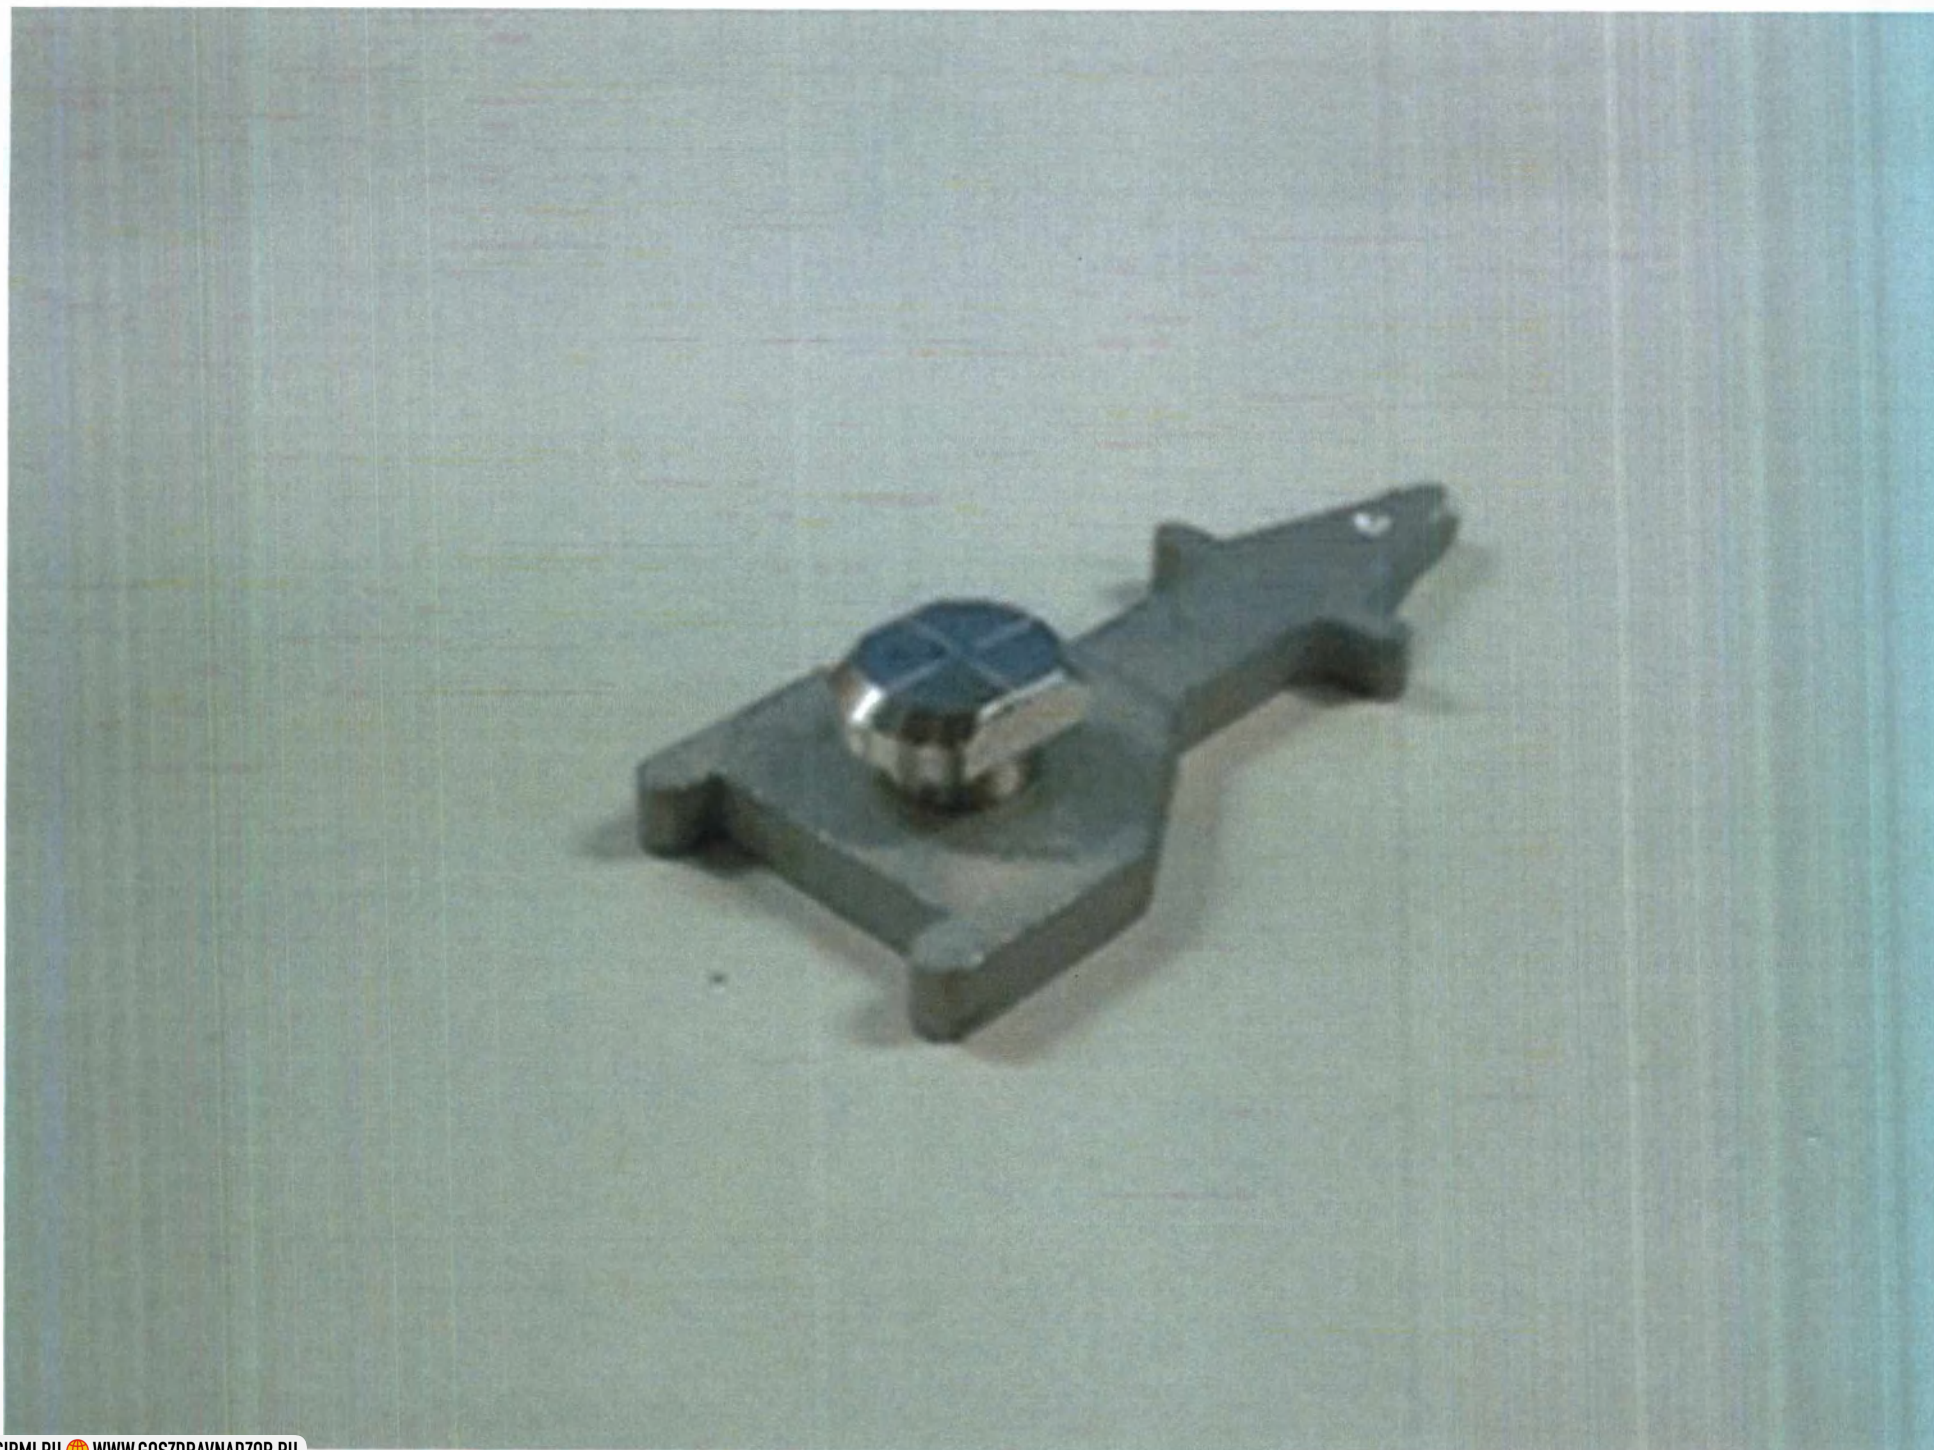


- направляющие для игл - не более 150 шт.;

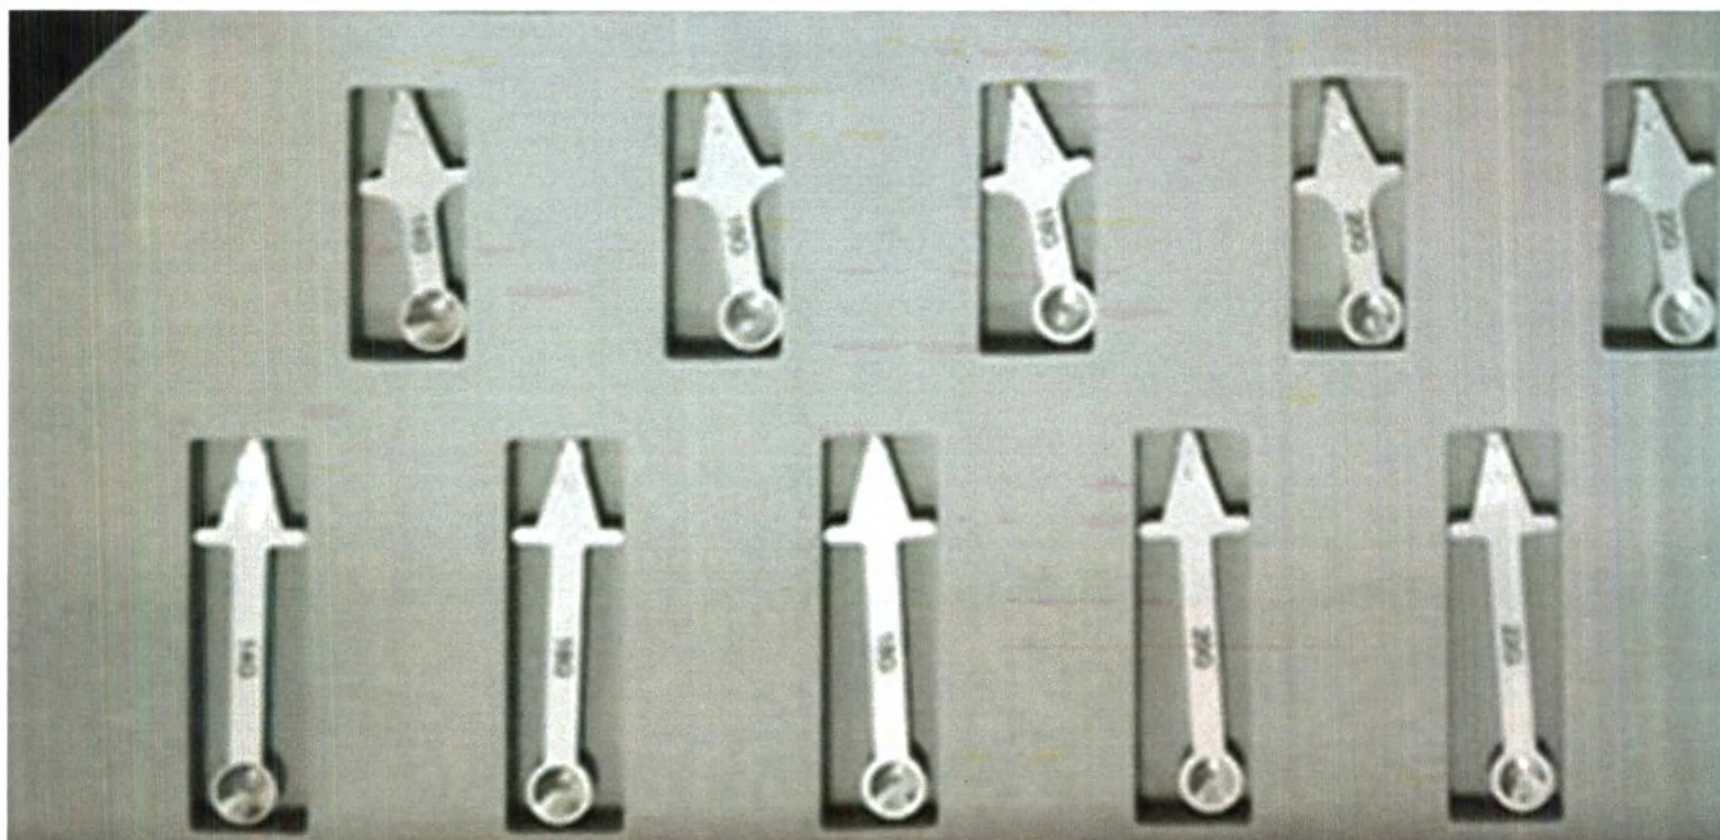

- пластина защитная;

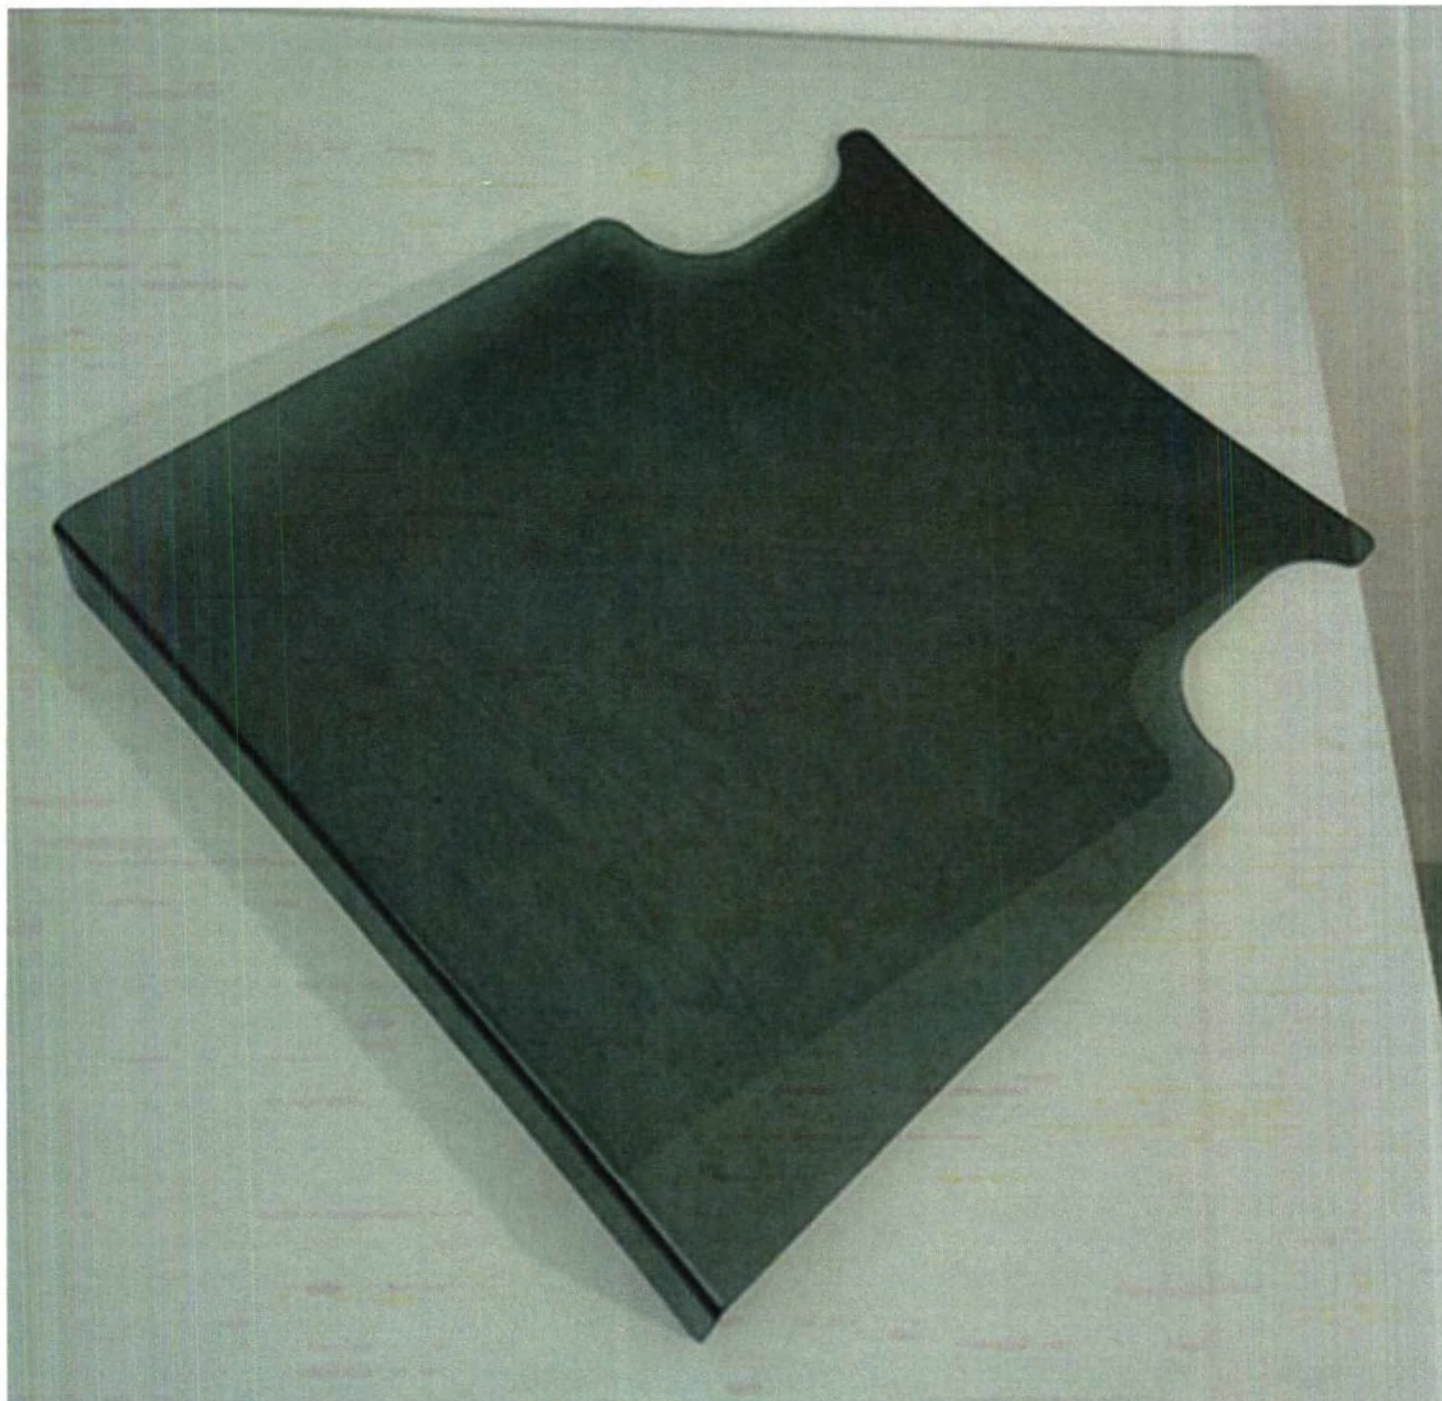

- фантом для калибровки;

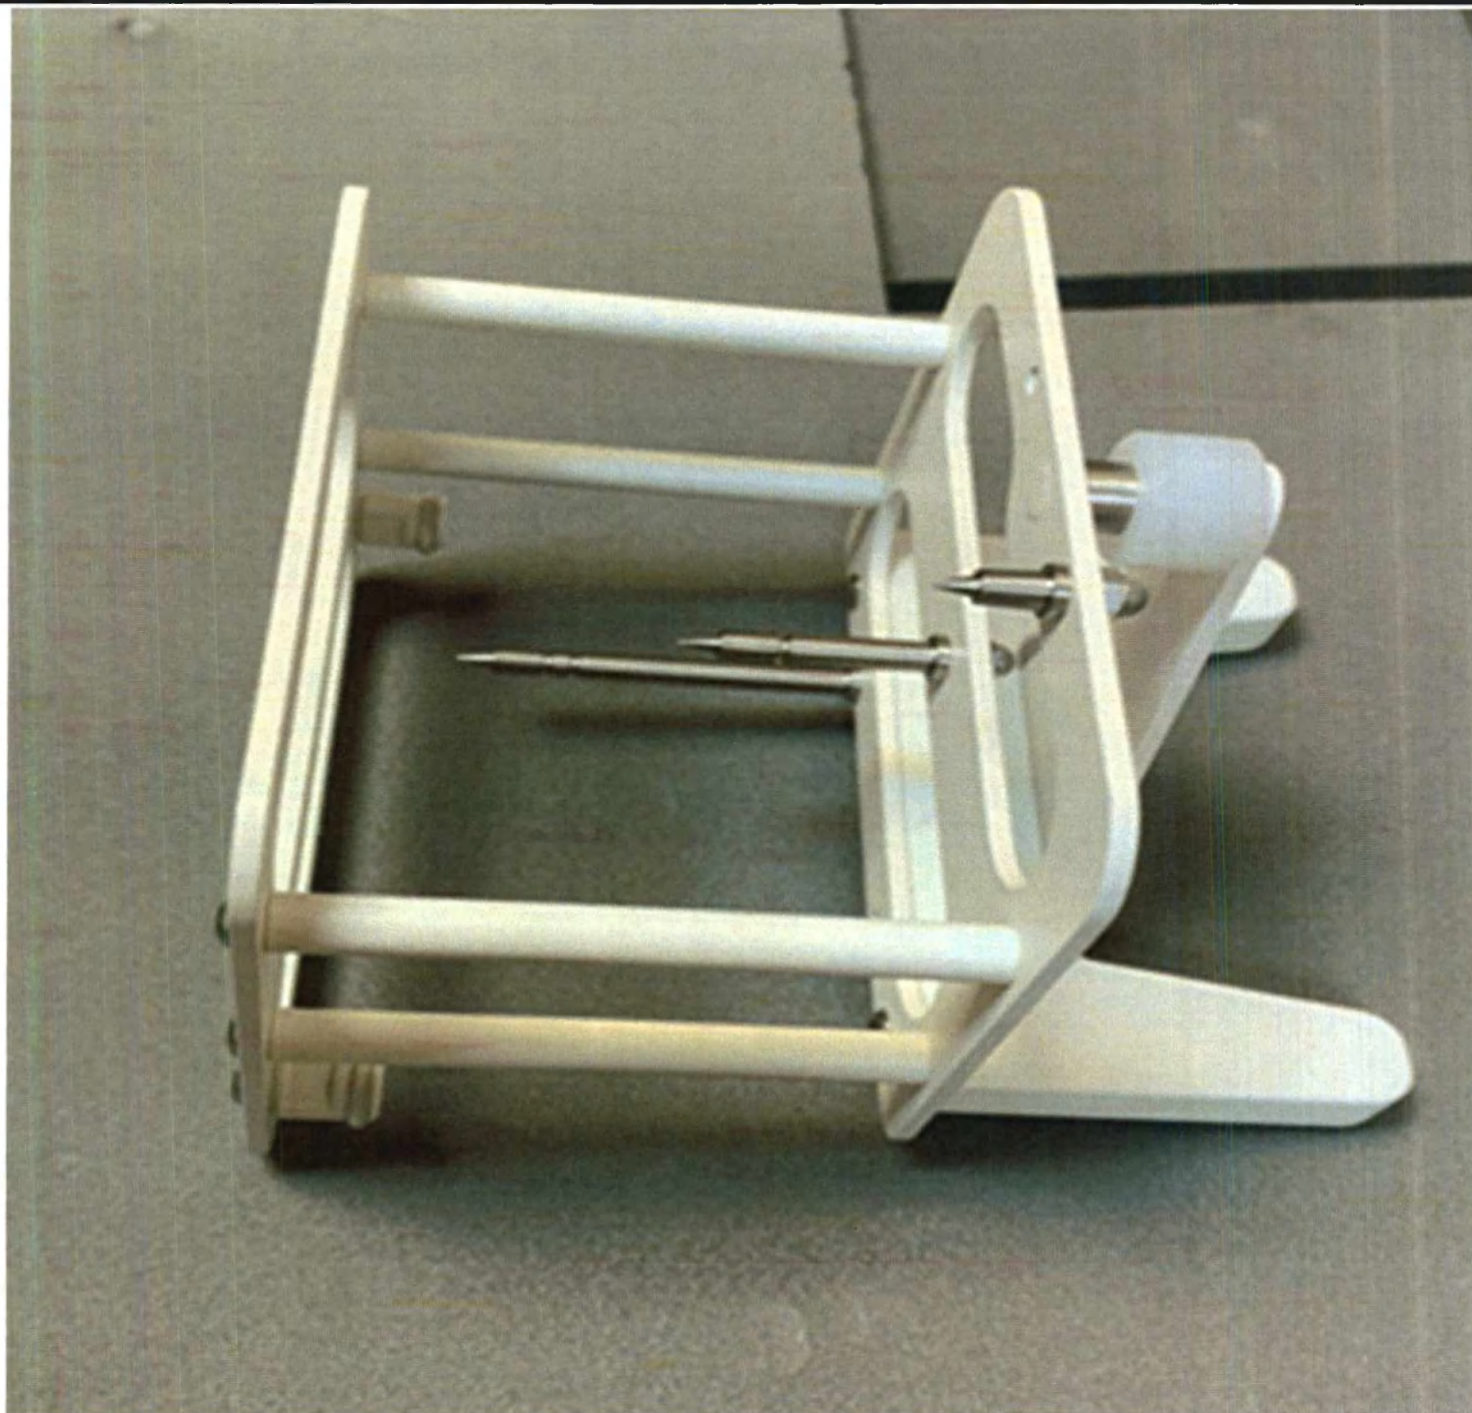

- направляющая для тест-иглы;



- программное обеспечение для биопсии;

The screenshot displays the Windows Registry Editor. The left pane shows the tree structure expanded to 'Computer > HKEY_CURRENT_USER > Environment > FUJIFILM FDR MS-3500 BIOPSY'. The 'Biopsy LIC' value is highlighted with a red rectangle. The right pane shows a list of registry values:

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)
TEMP	REG_EXPAND_SZ	%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
TMP	REG_EXPAND_SZ	%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp





- фиксаторы направляющей для игл - 2 шт.





71. Набор для латеральной биопсии

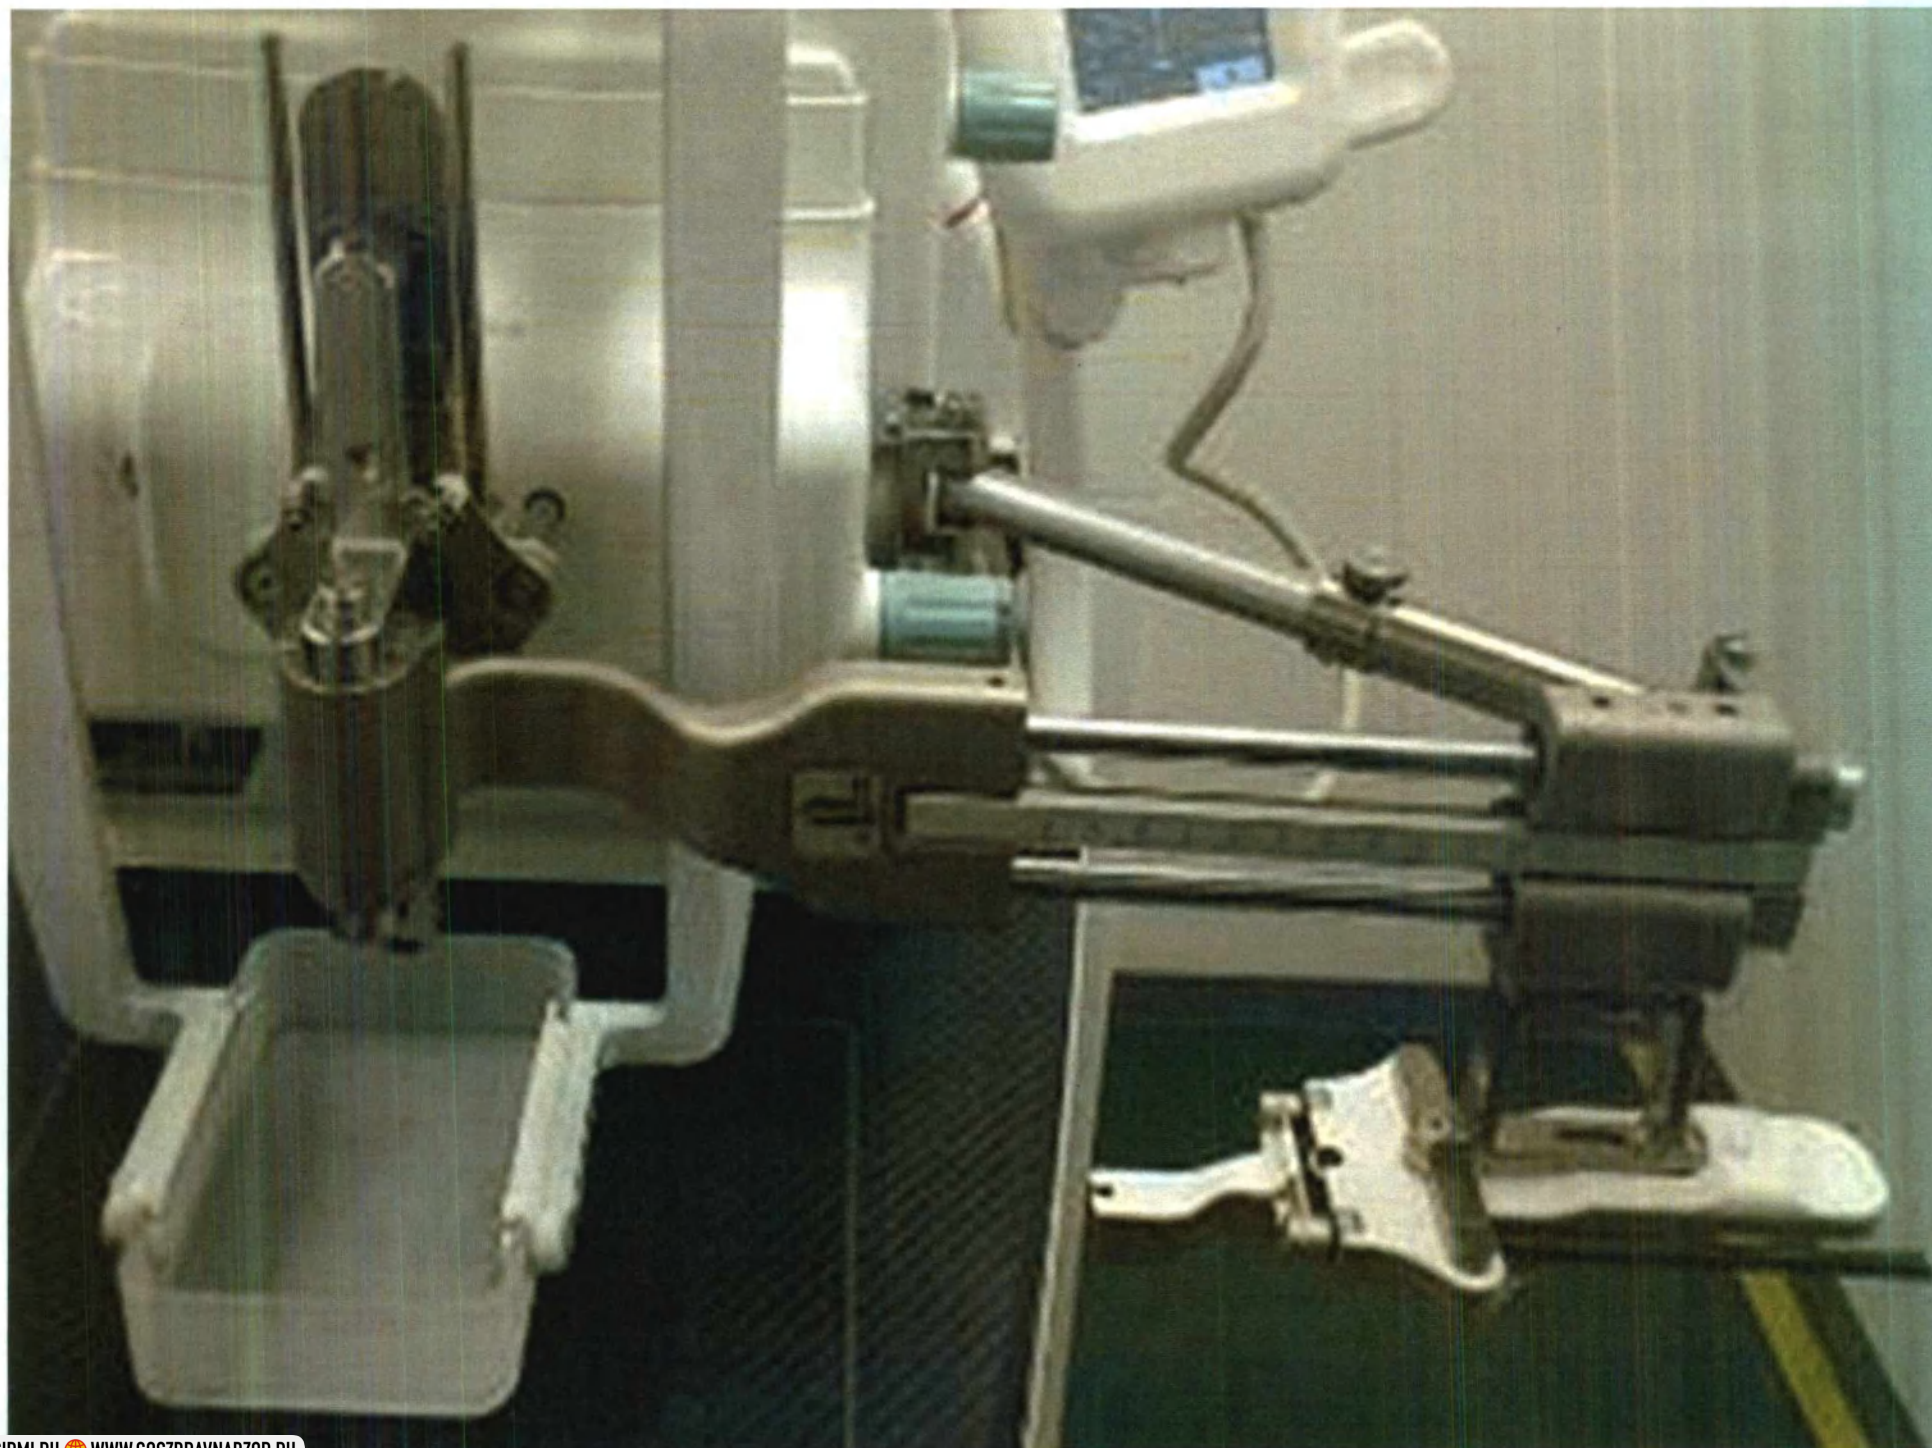


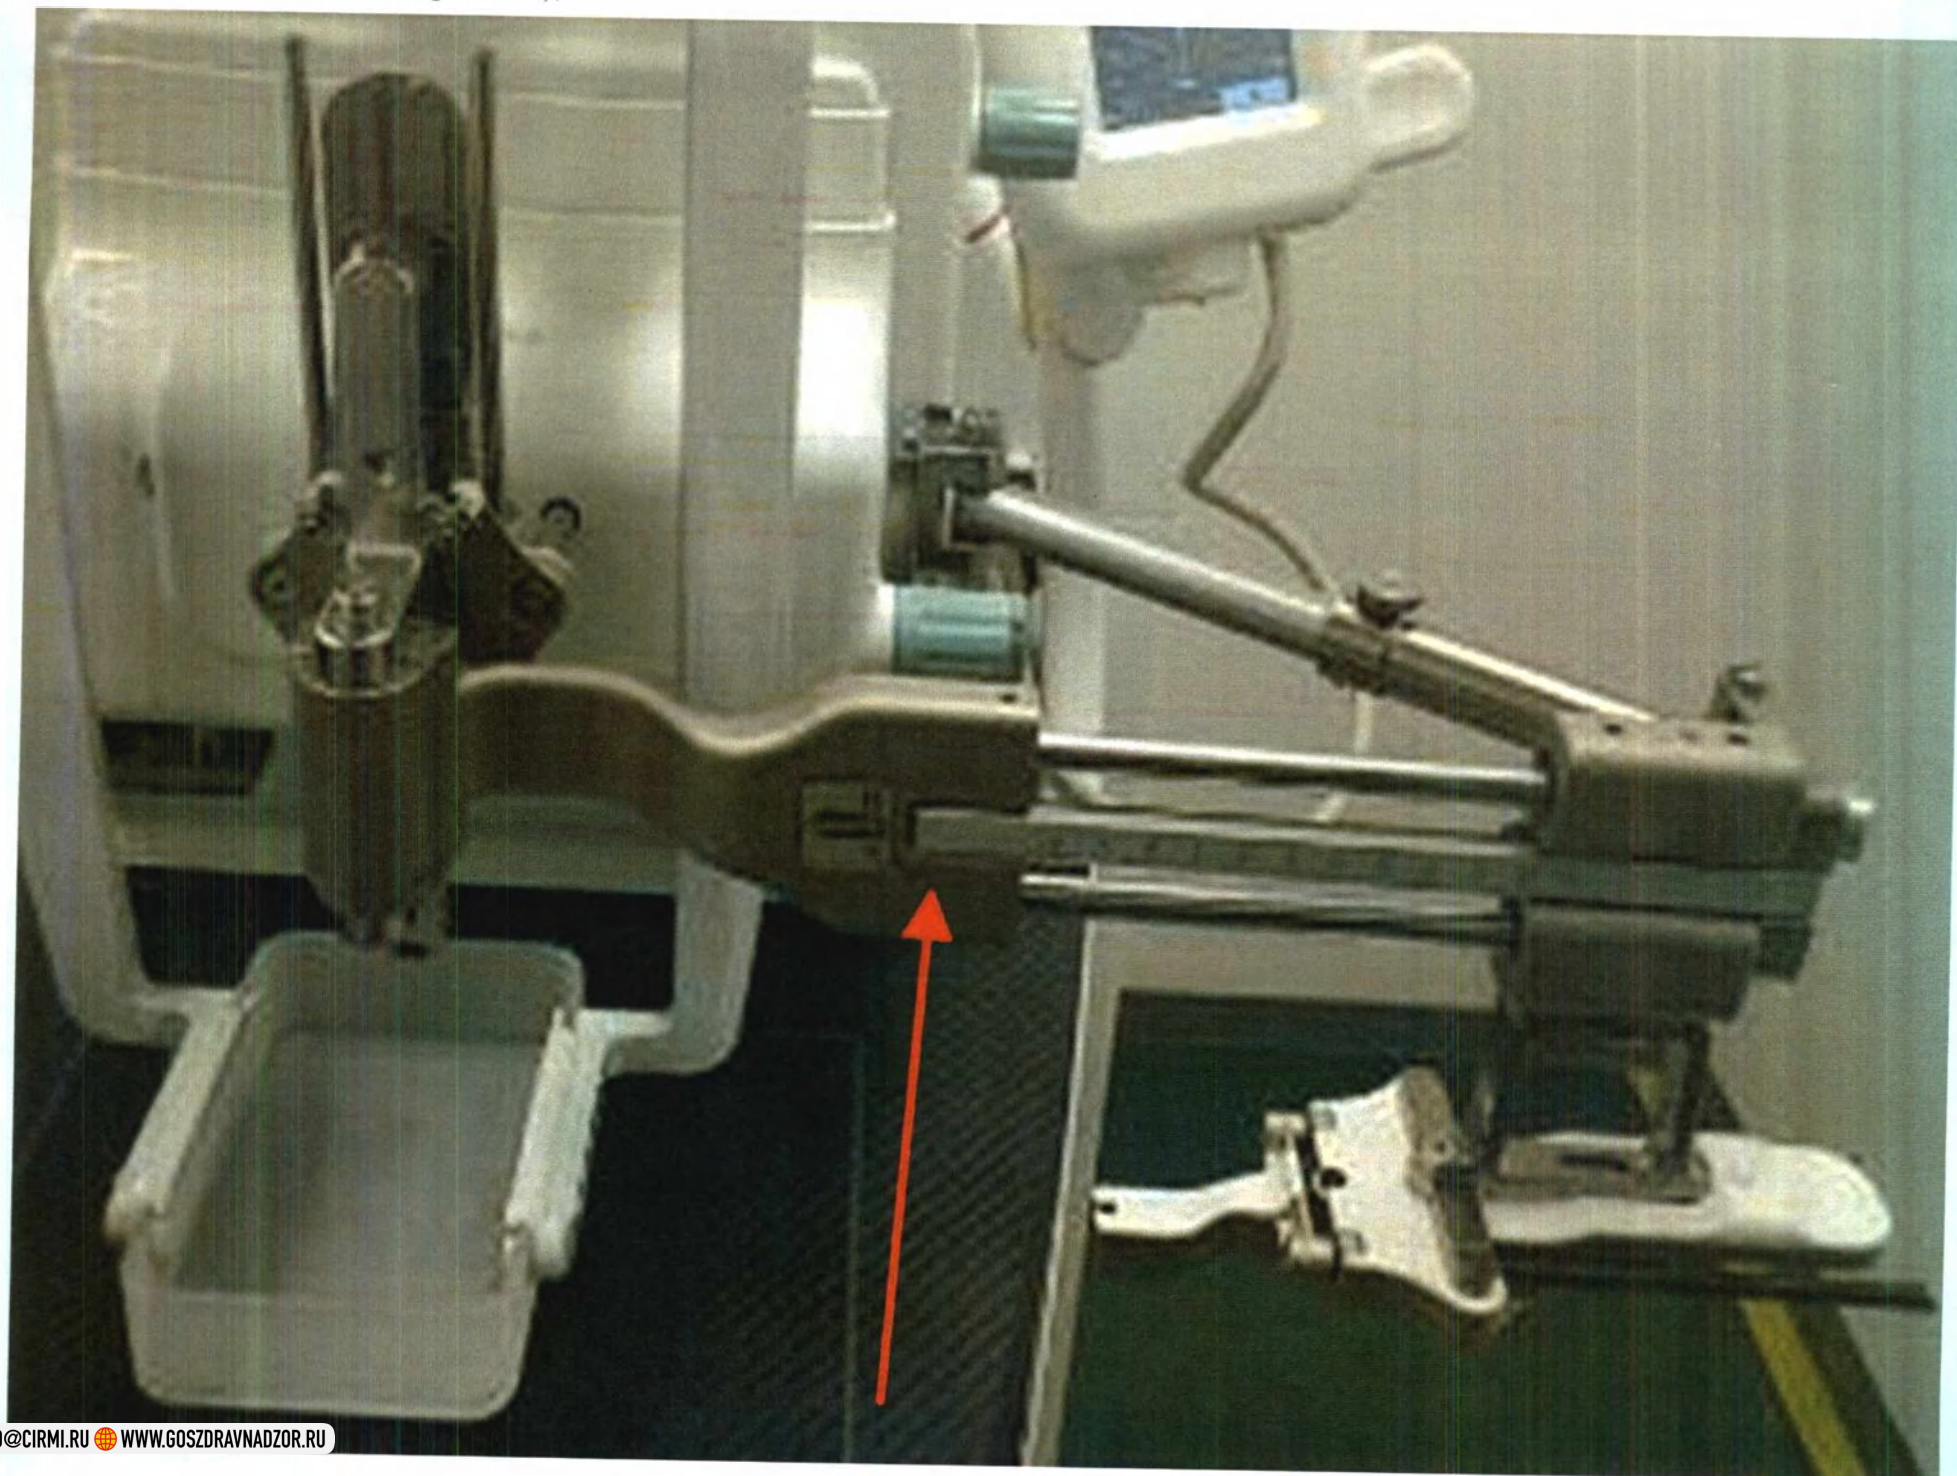


- пластина компрессионная для латеральной биопсии;




- фантом для калибровки для латеральной биопсии;

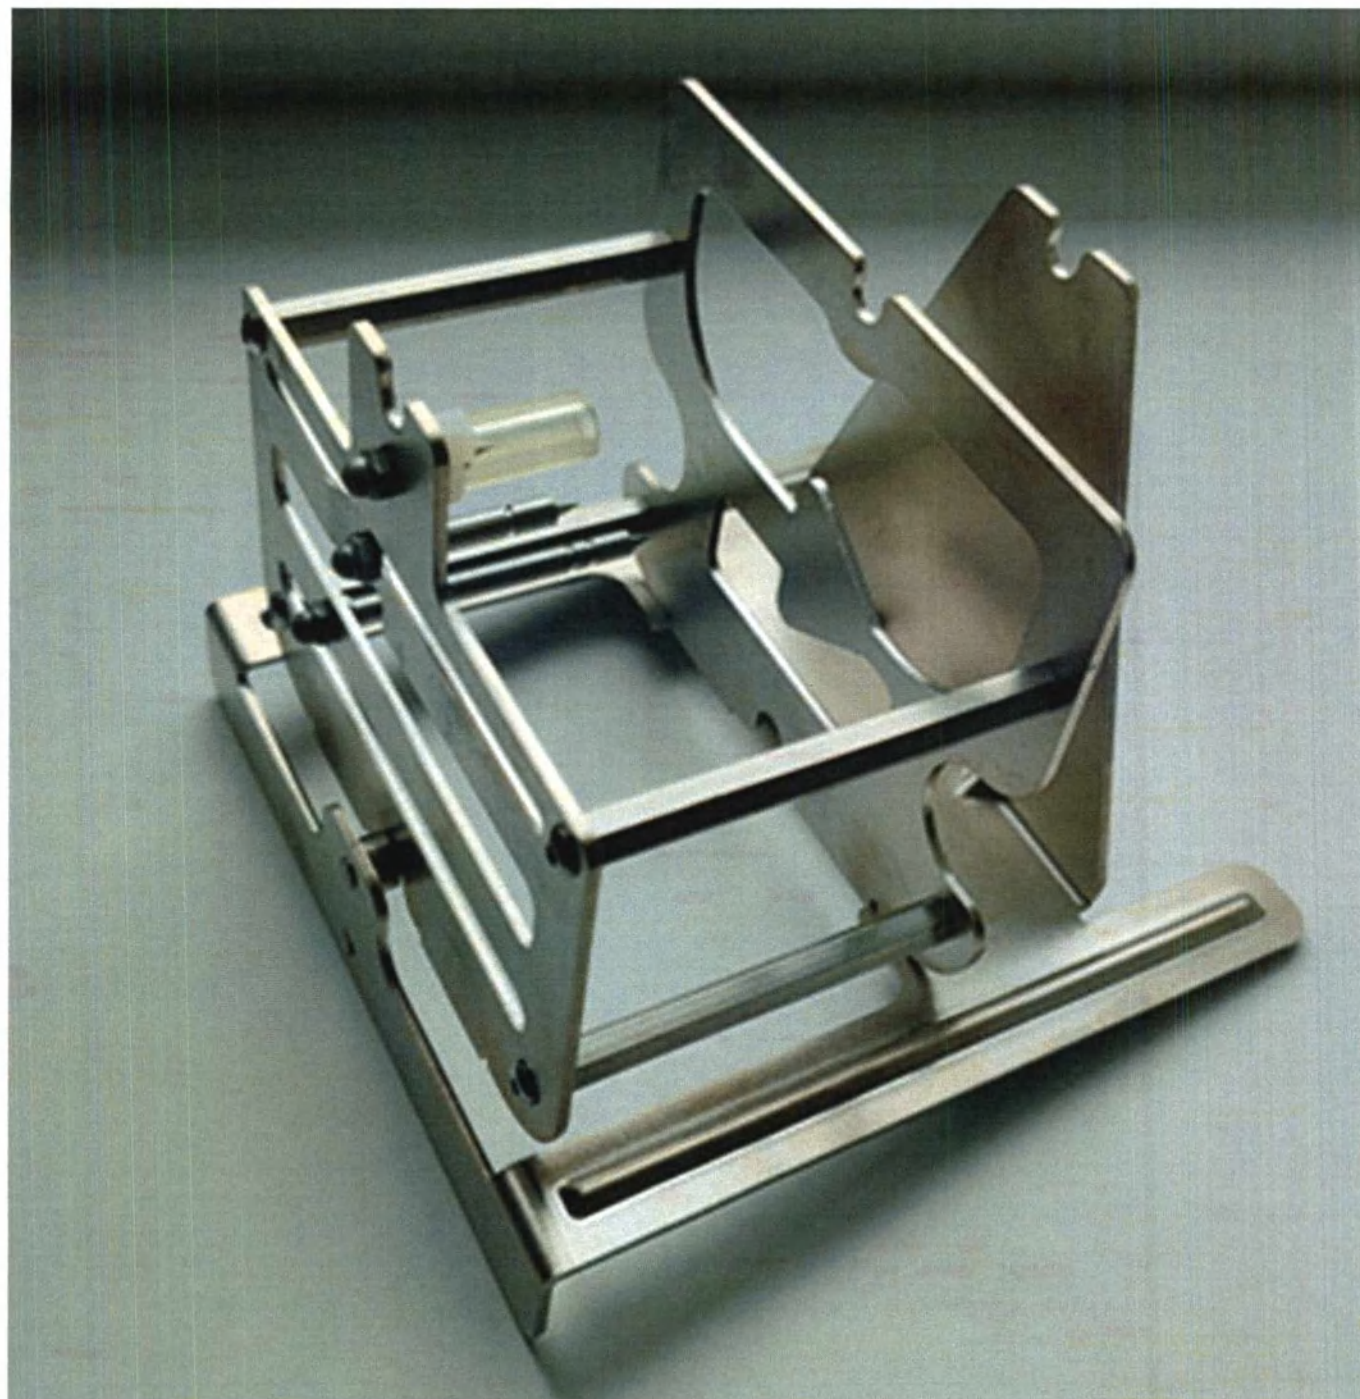

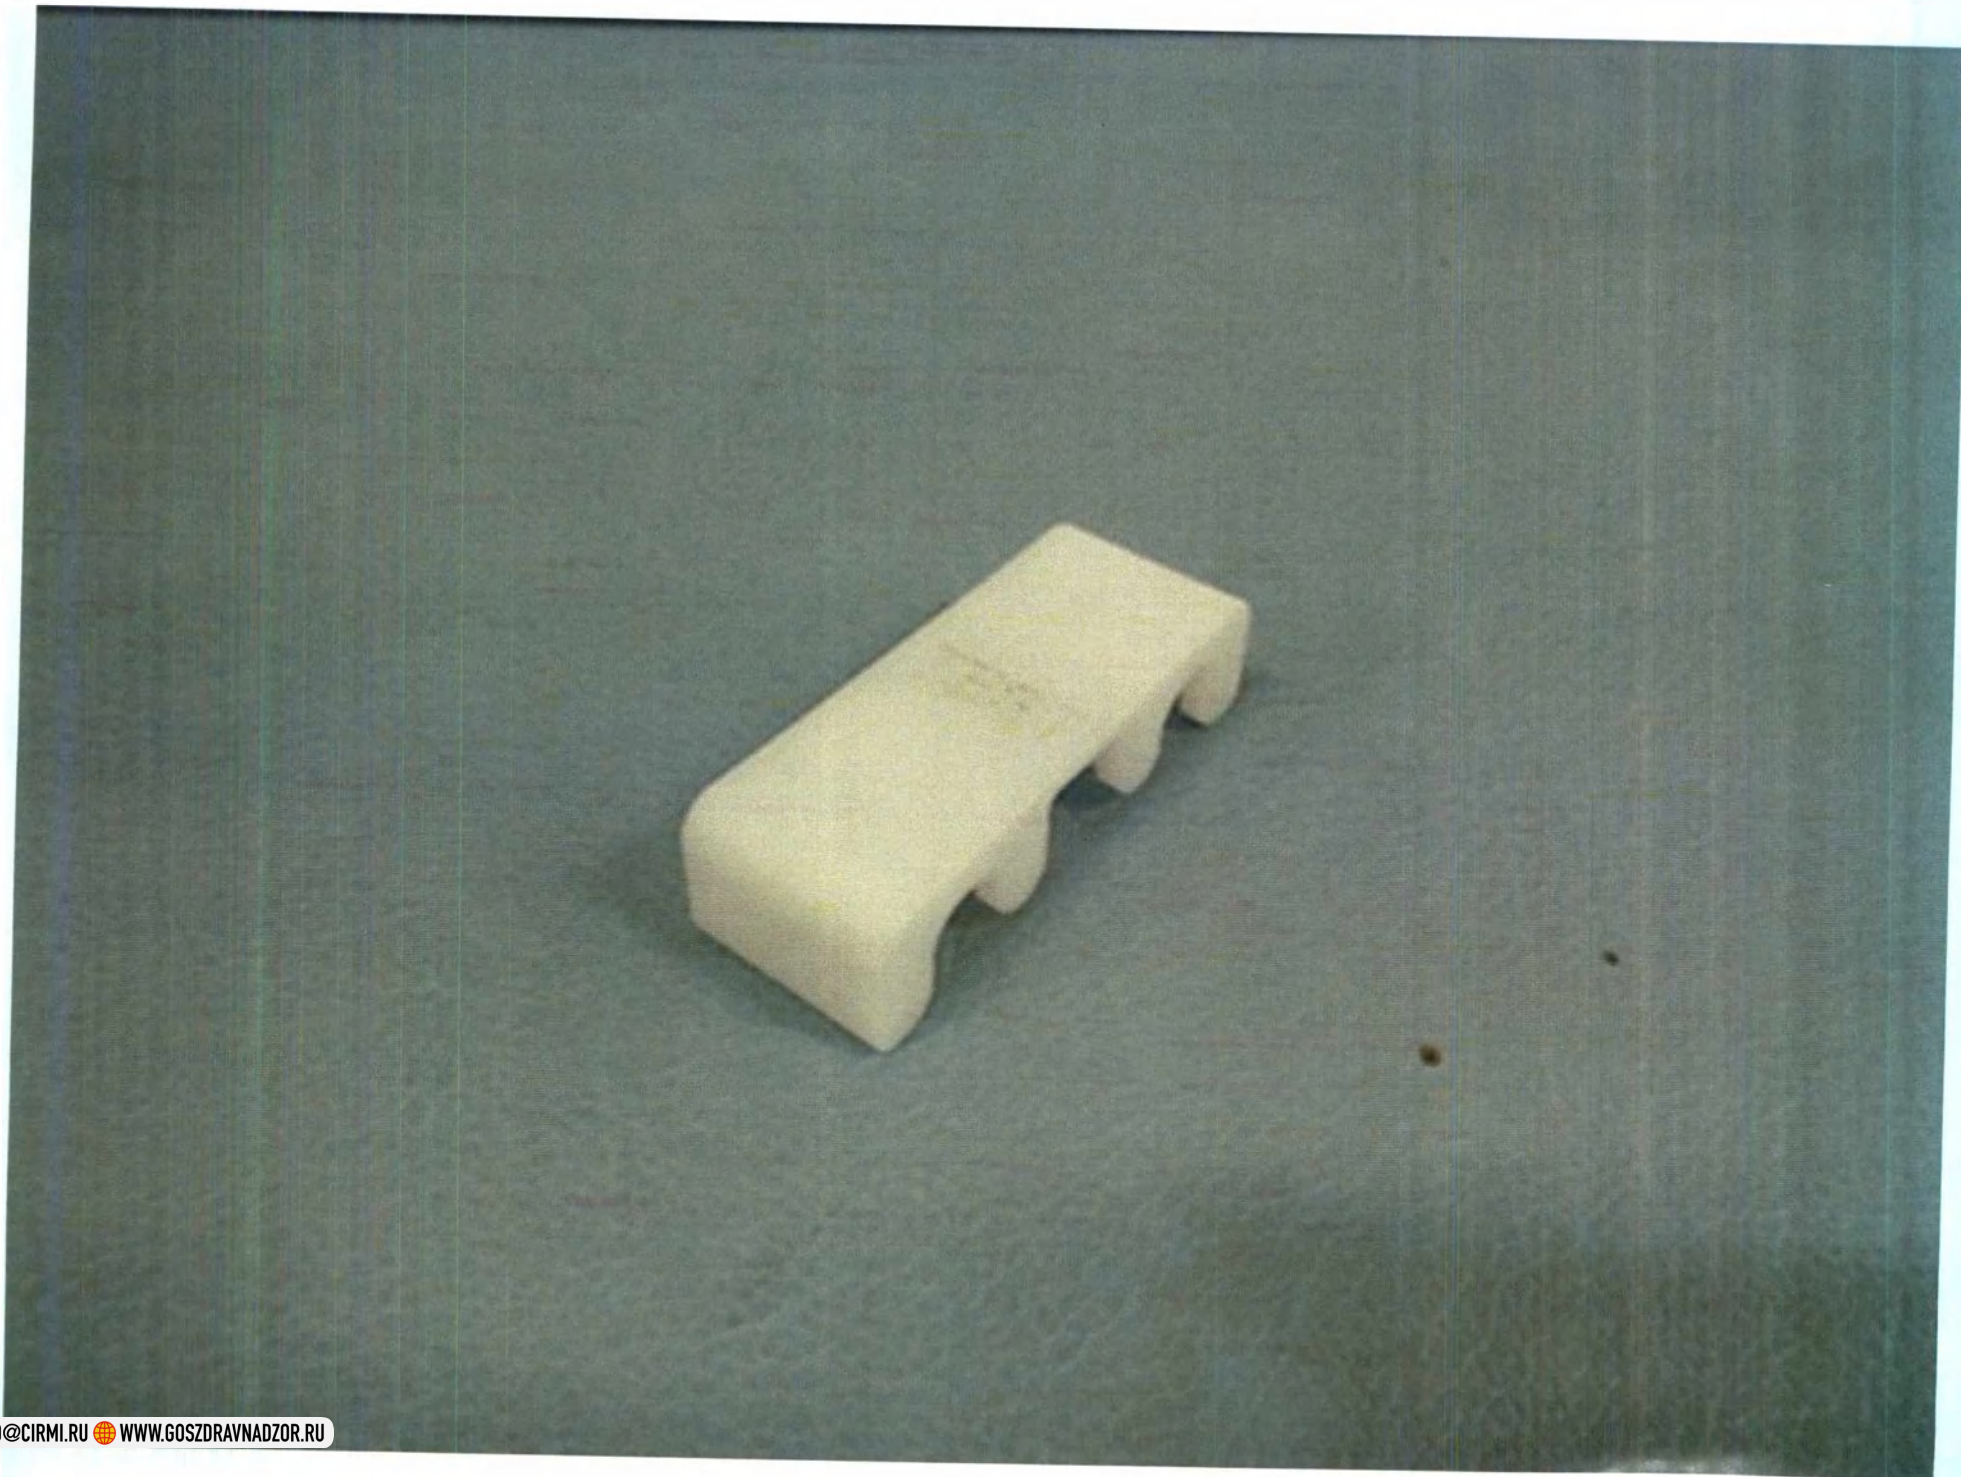





- фиксатор для направляющей для игл - 2 шт.

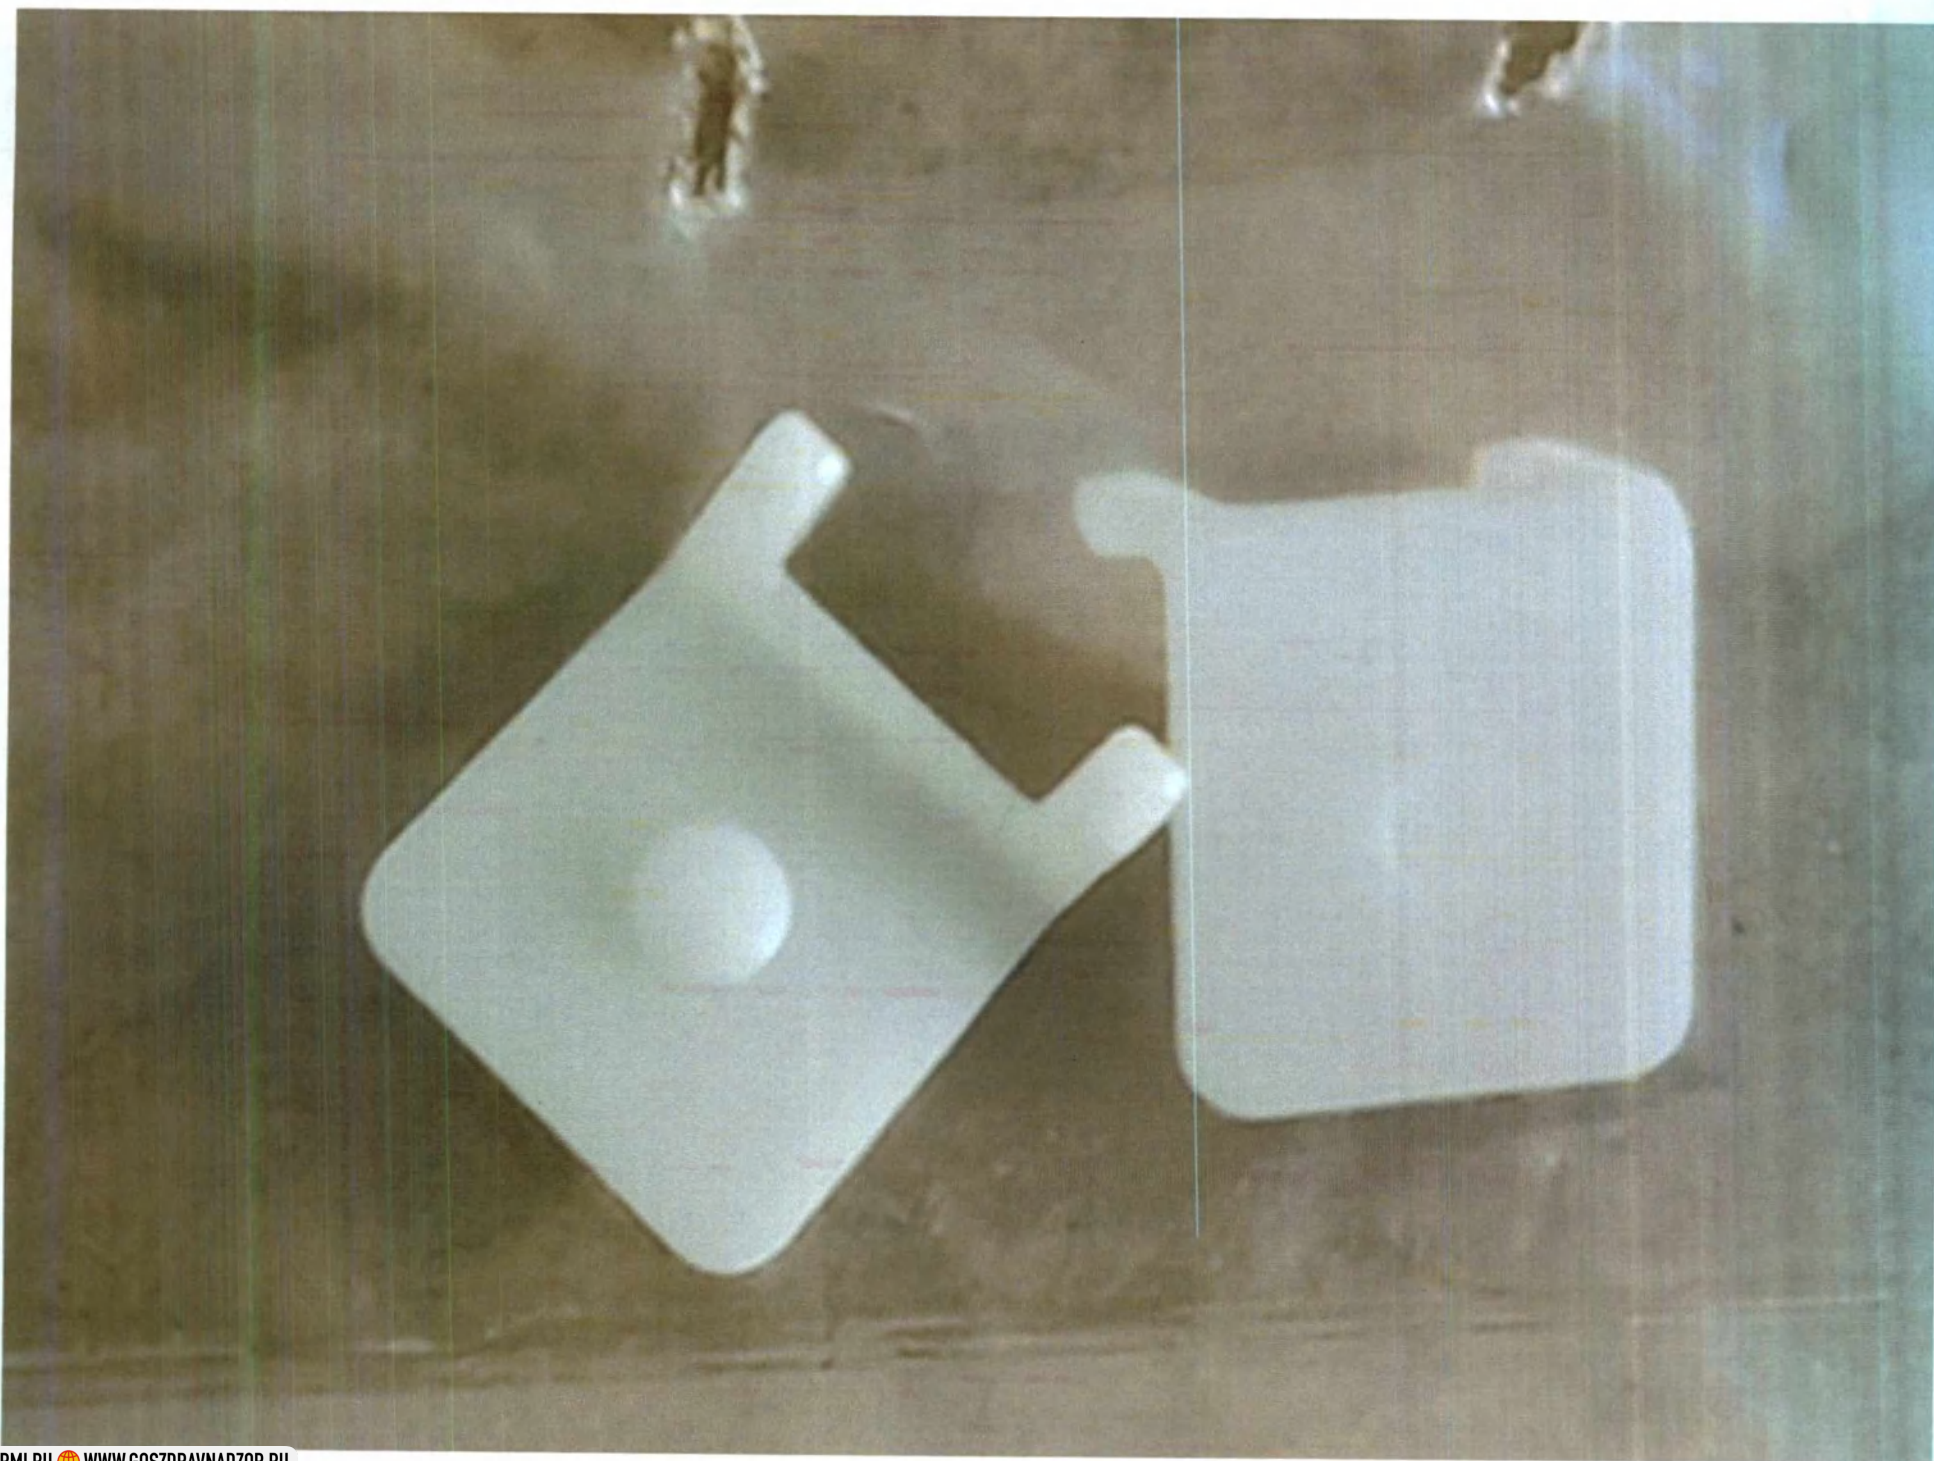


72. Ограничители для иглы латеральной биопсии, тип М – не более 3шт.

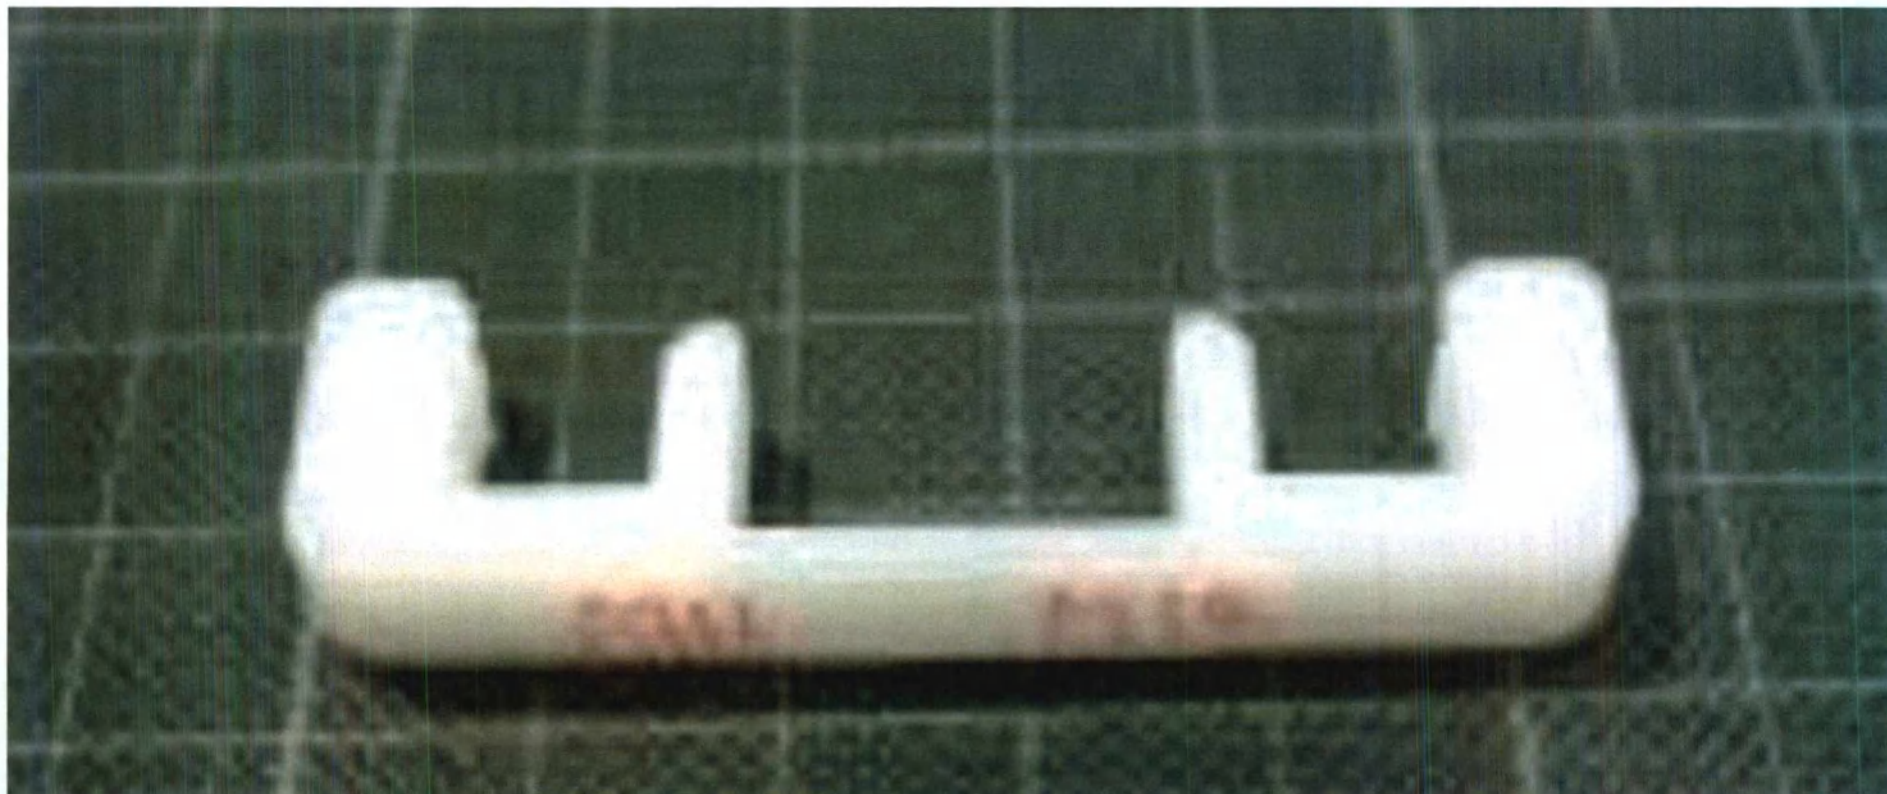


73. Ограничители для иглы латеральной биопсии, тип С – не более 3 шт.

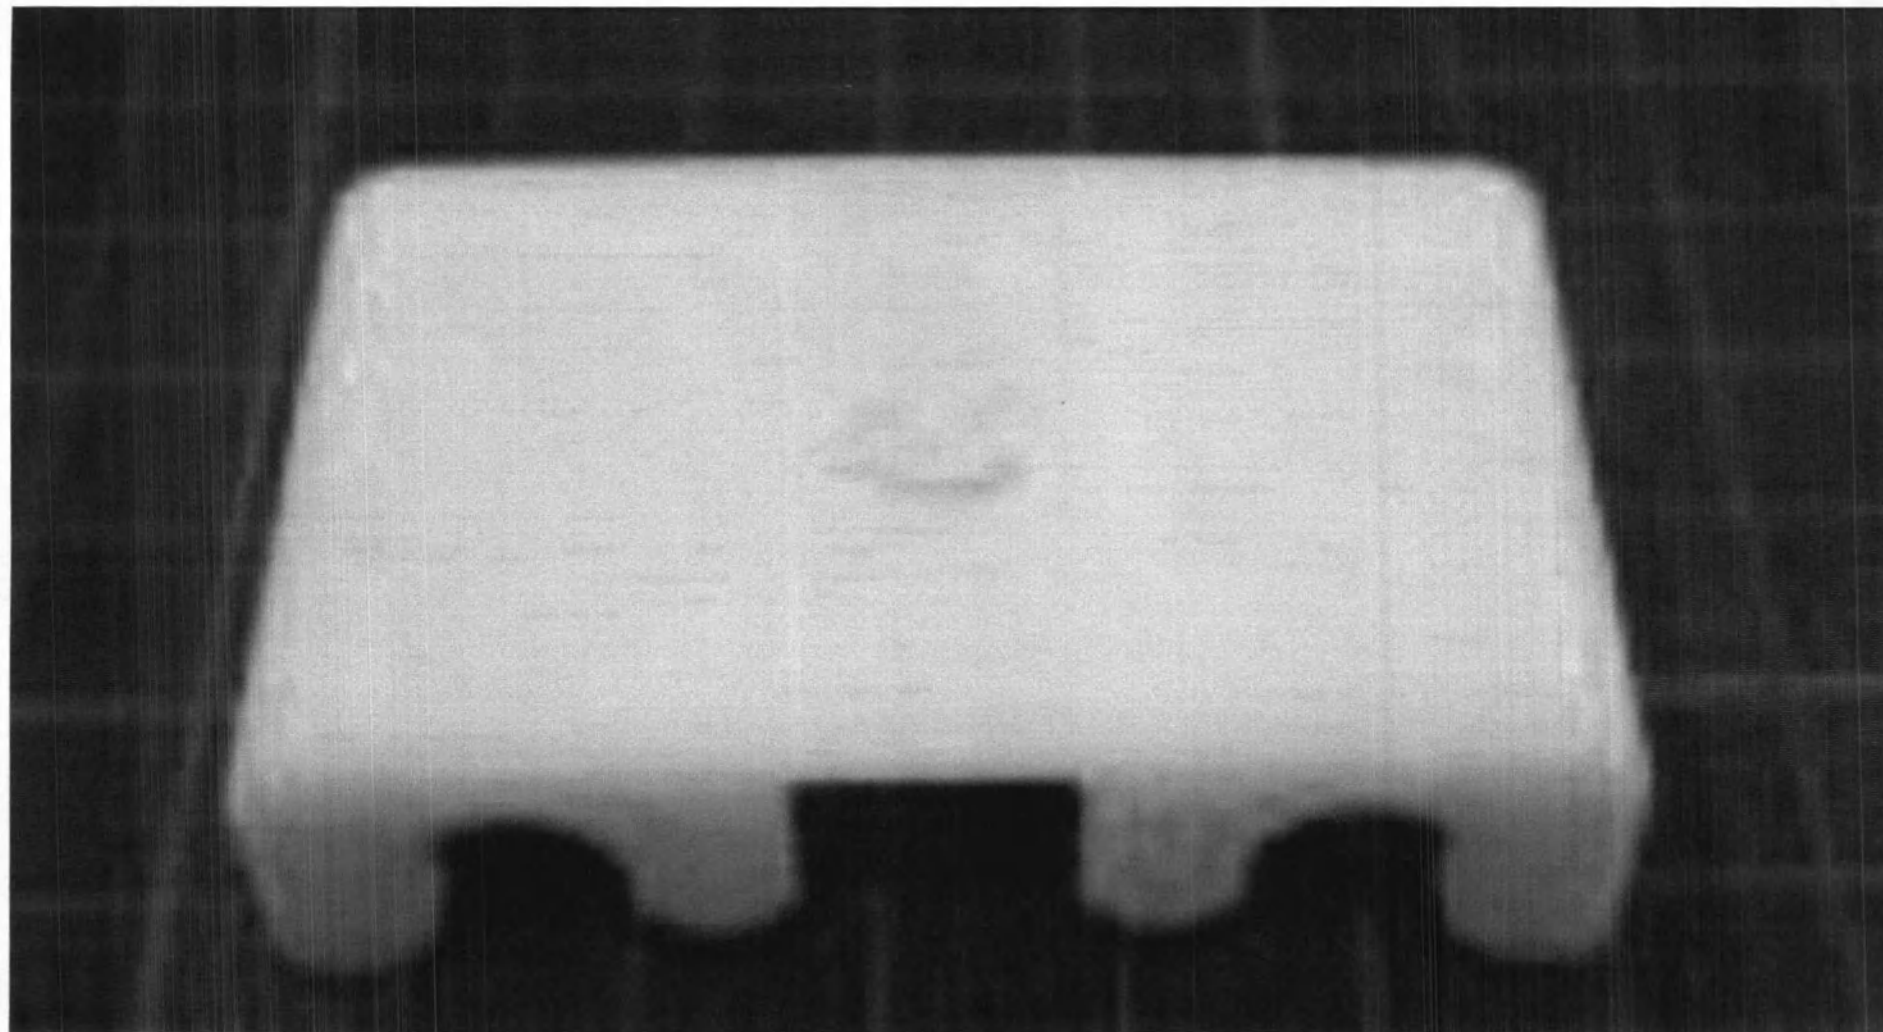


74. Ограничители для иглы латеральной биопсии, тип V – не более 3 шт.

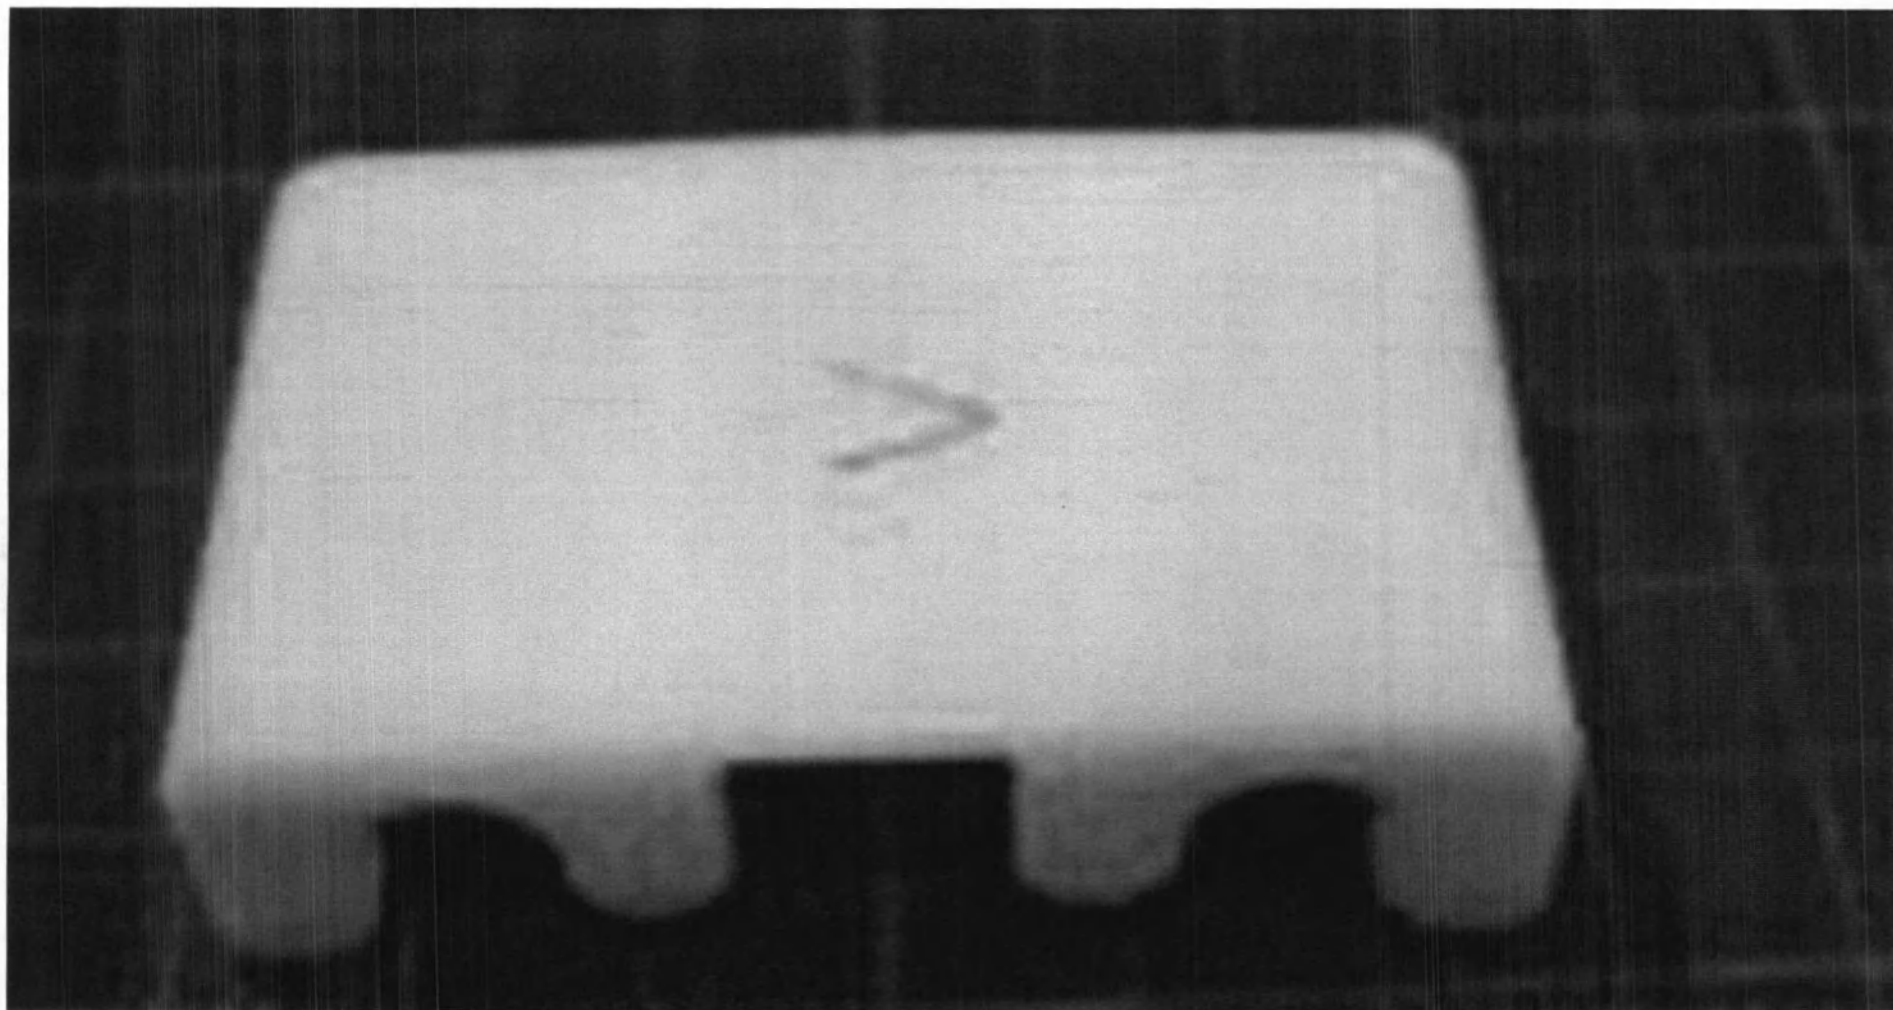


75. Ограничители для иглы латеральной биопсии, тип Е – не более 3 шт.

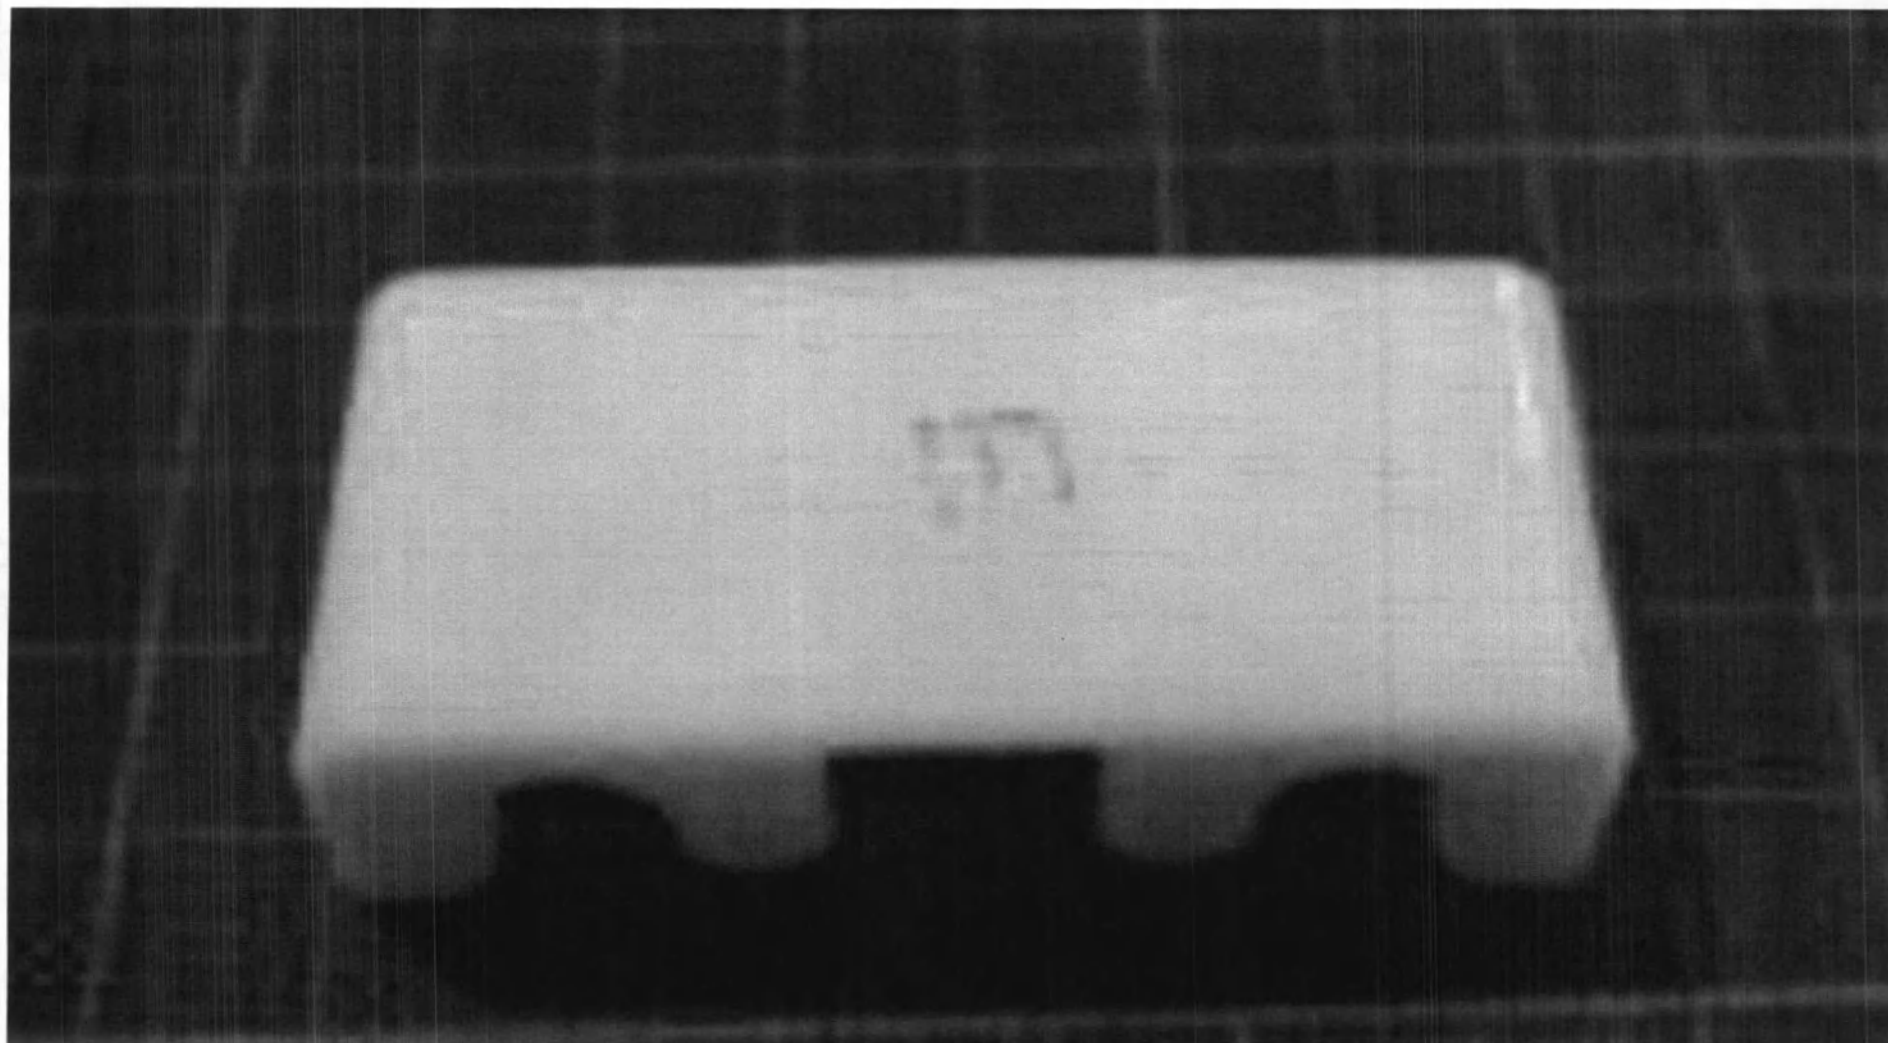

76. Ограничители для иглы латеральной биопсии, для теста – не более 3 шт.

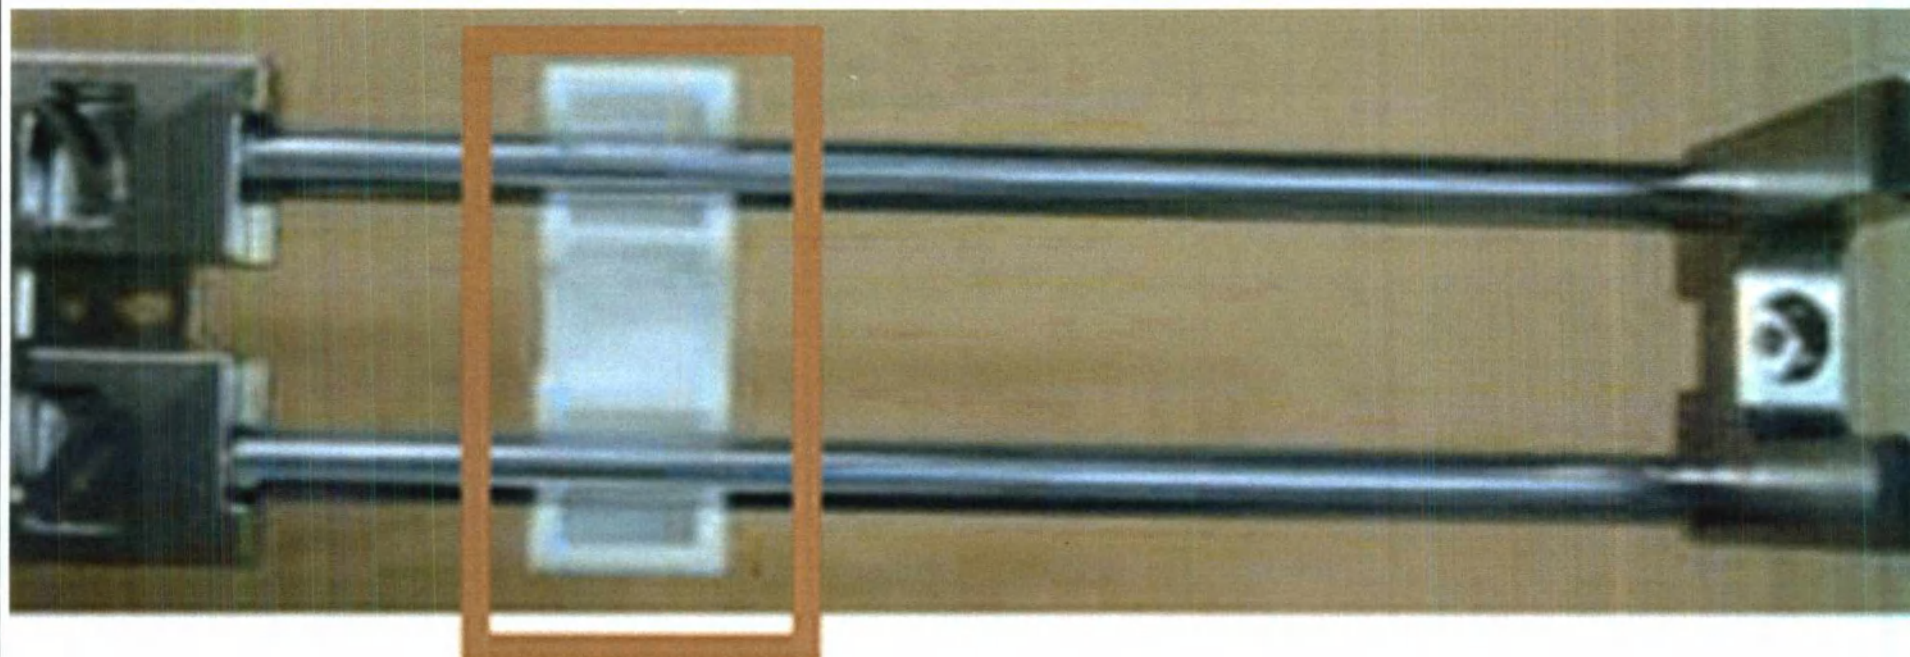

76. Ограничители для иглы латеральной биопсии, для теста – не более 3 шт.

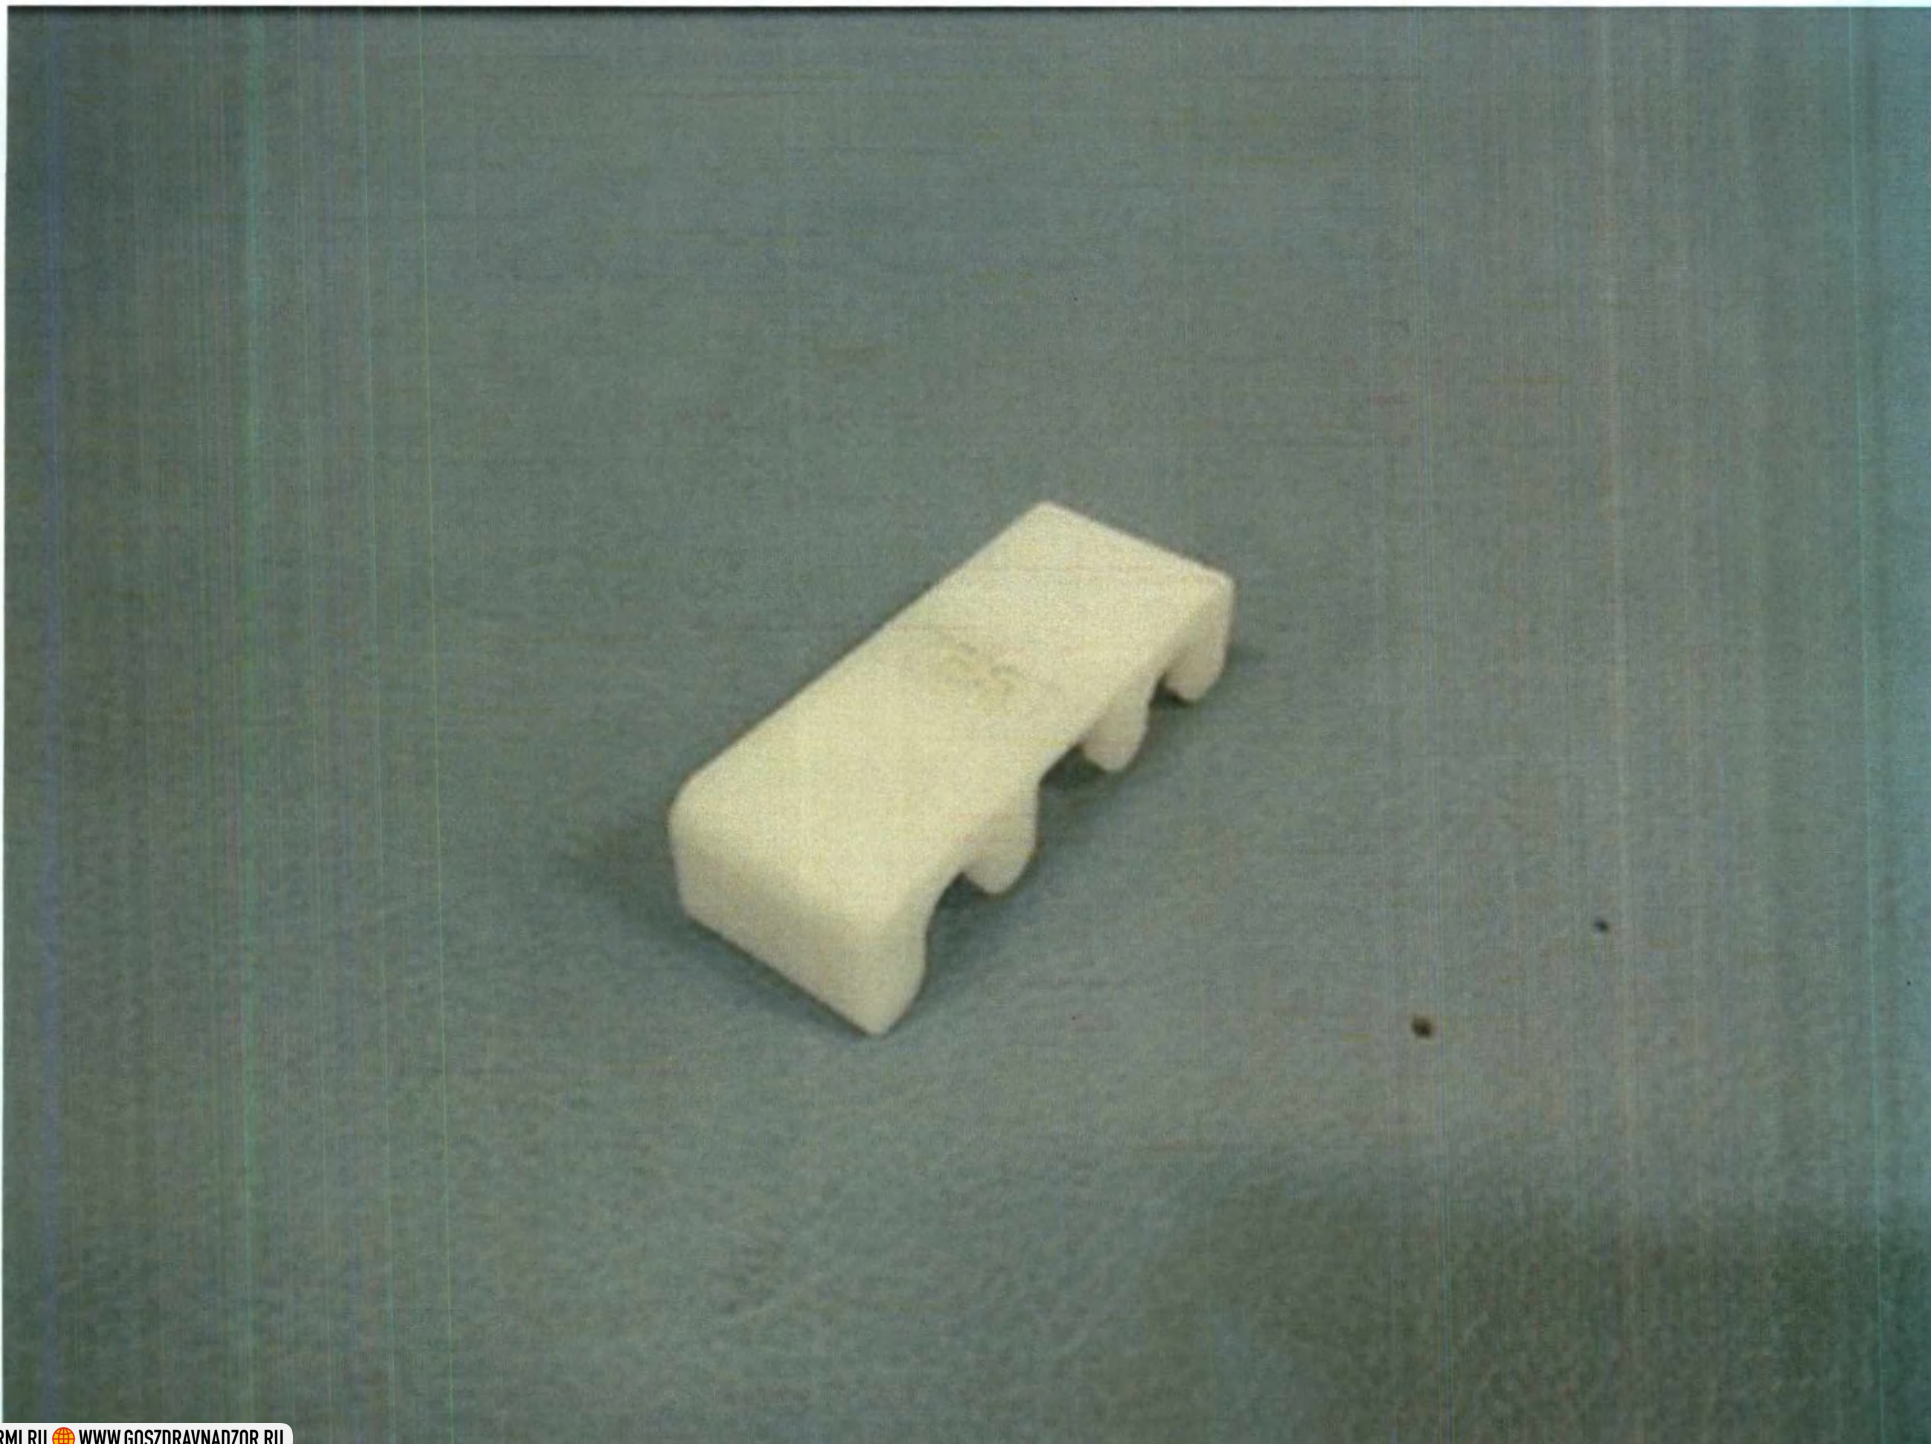




78. Держатель игл, тип М/С – не более 3 шт.



79. Держатель игл, тип V – не более 3 шт.



80. Держатель игл, тип Е – не более 3 шт.

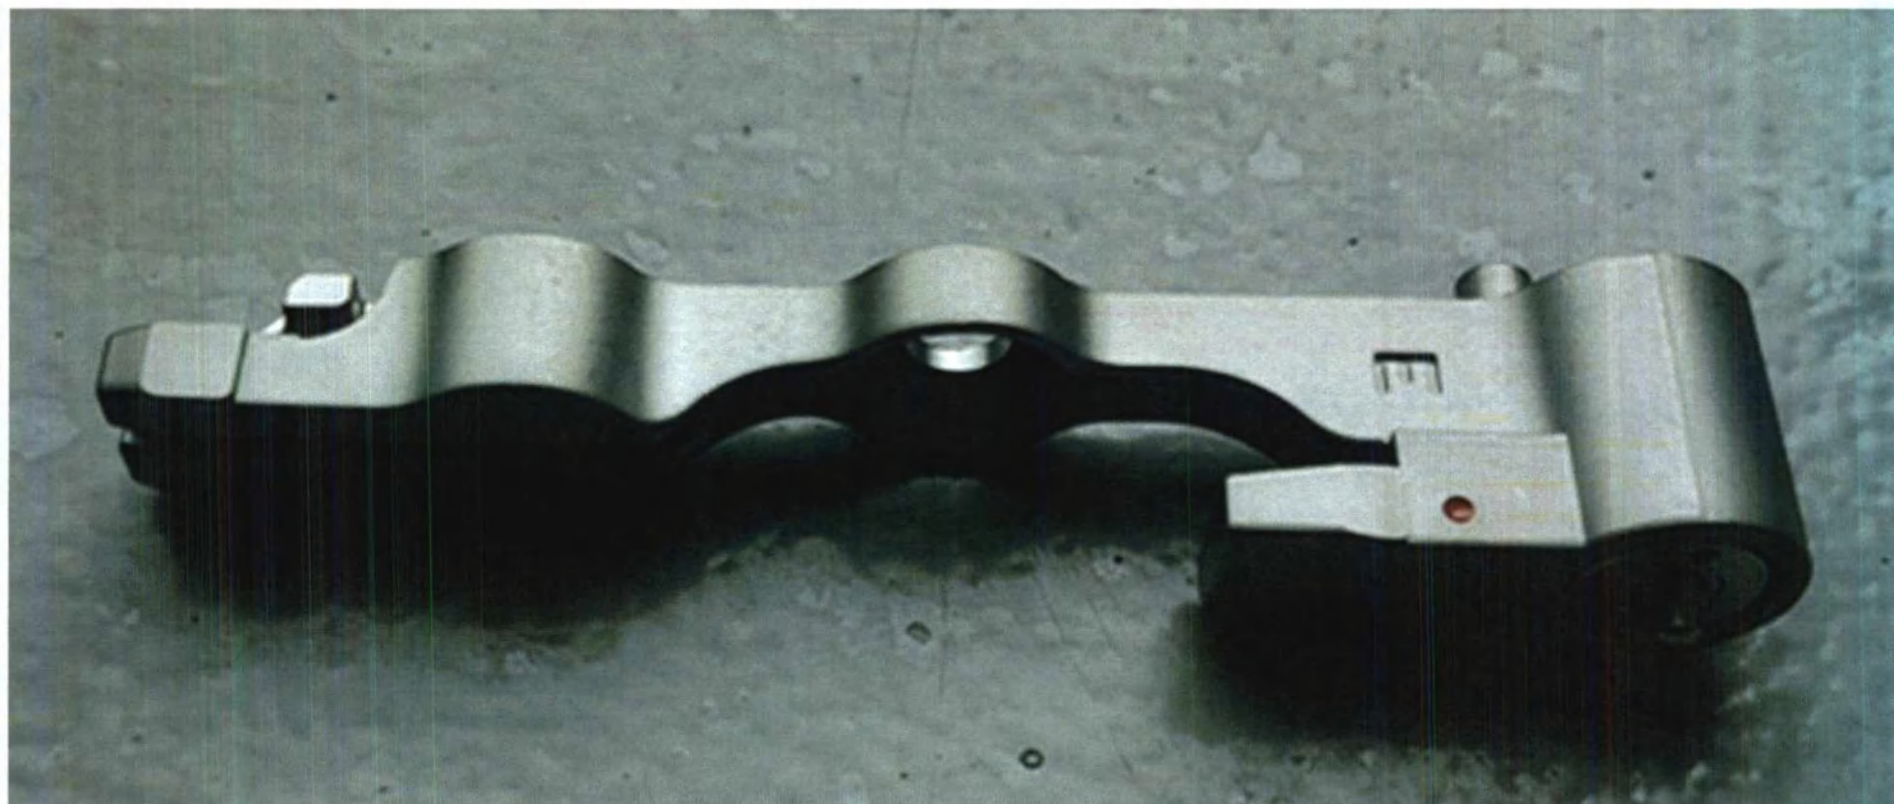

81. Фиксаторы для направляющей для игл - не более 20 шт.



82. Направляющие для игл (металлические), тип M/V – не более 10 шт.



83. Направляющие для игл (металлические), тип С 12G Е - не более 10 шт.



84. Направляющие для игл (металлические), тип С 14G Е - не более 10 шт.




85. Направляющие для игл (металлические), тип С 16G Е - не более 10 шт.



86. Направляющие для игл (металлические), тип С 18G Е - не более 10 шт.




87. Направляющие для игл (металлические), тип С 20G Е - не более 10 шт.

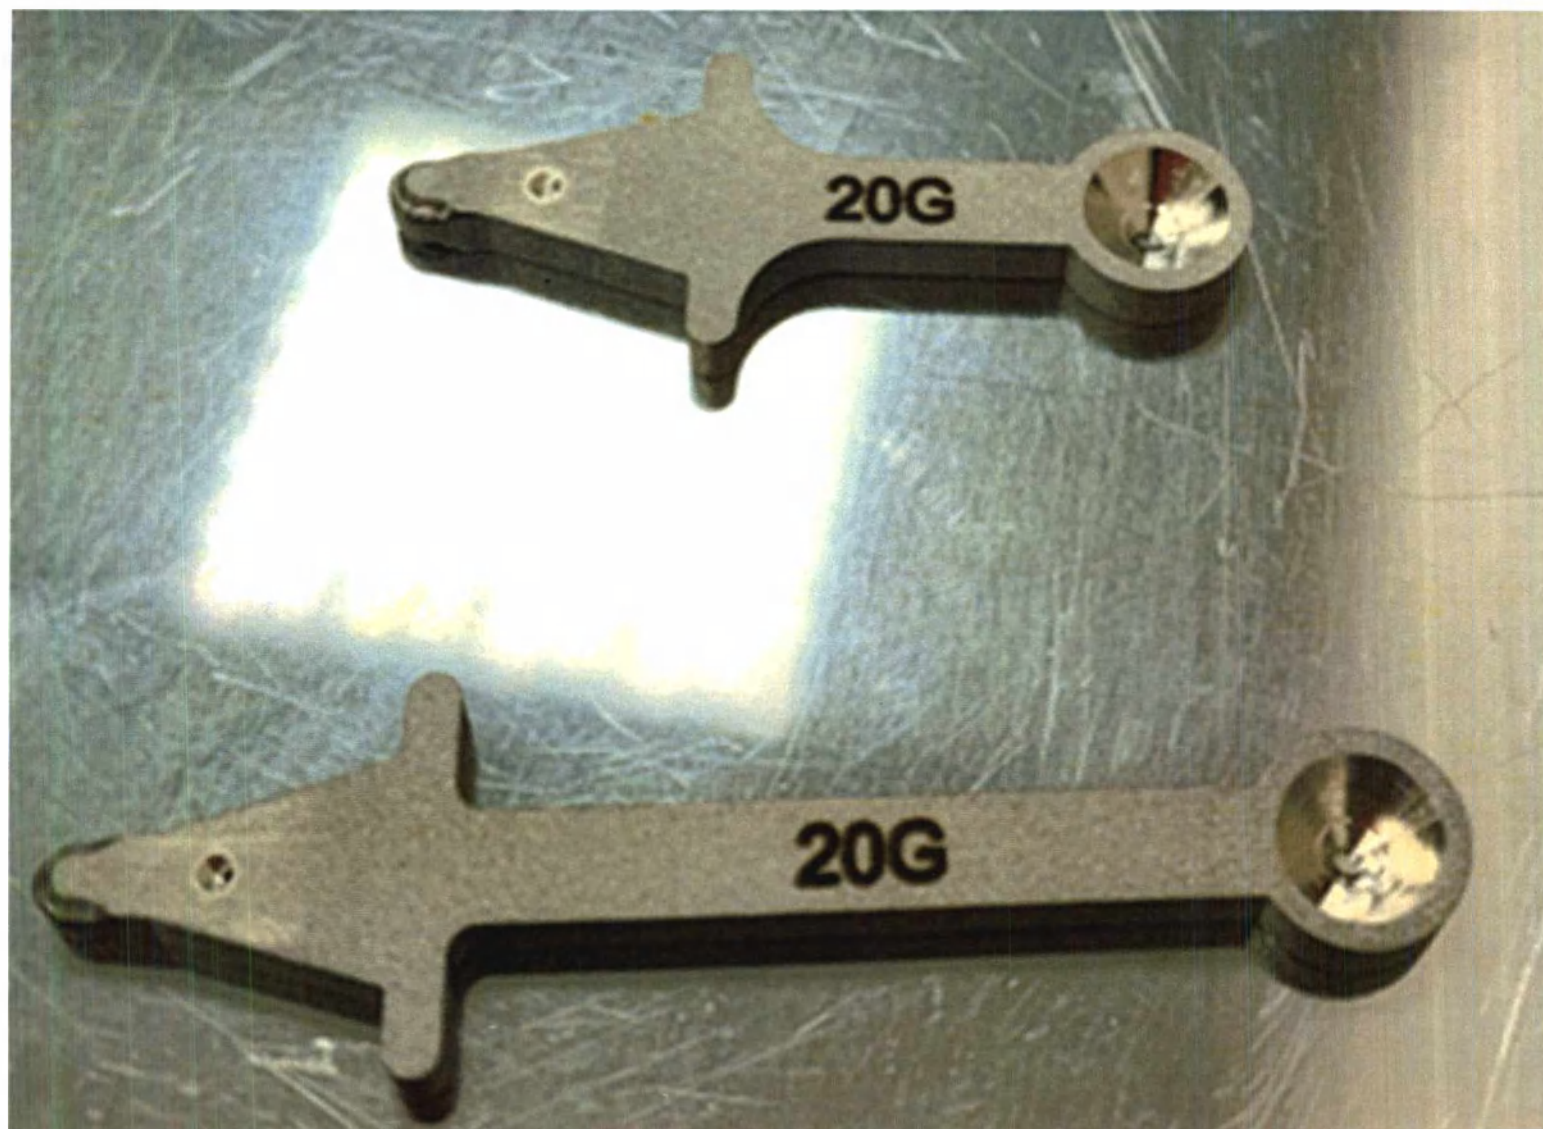


88. Направляющие для игл (металлические), тип С 22G Е - не более 10 шт.



89. Наклейка декоративная для маммографической установки— не более 5 шт.

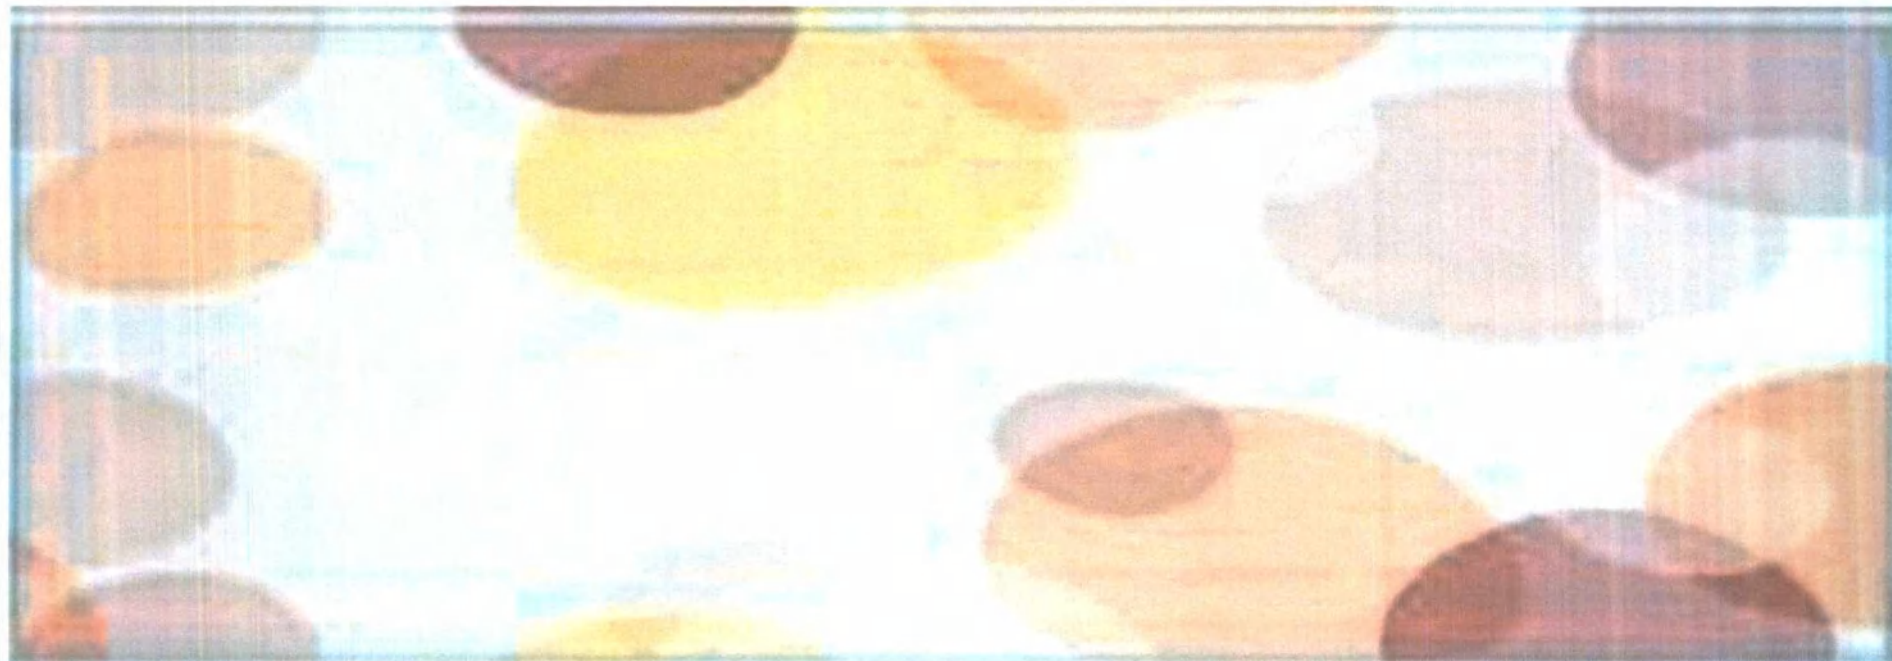

89. Наклейка декоративная для маммографической установки– не более 5 шт.

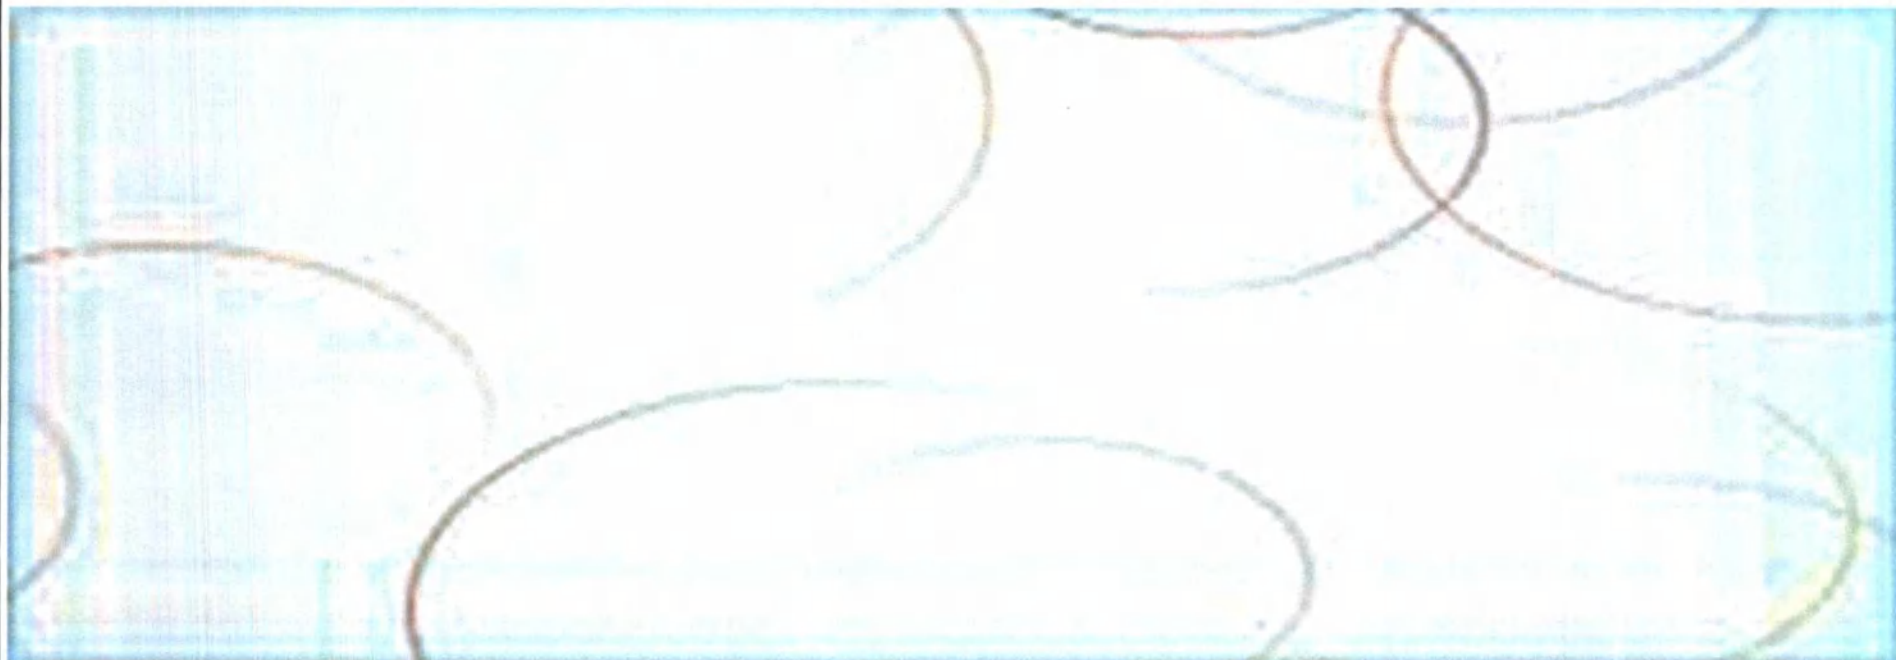


89. Наклейка декоративная для маммографической установки– не более 5 шт.



89. Наклейка декоративная для маммографической установки— не более 5 шт.





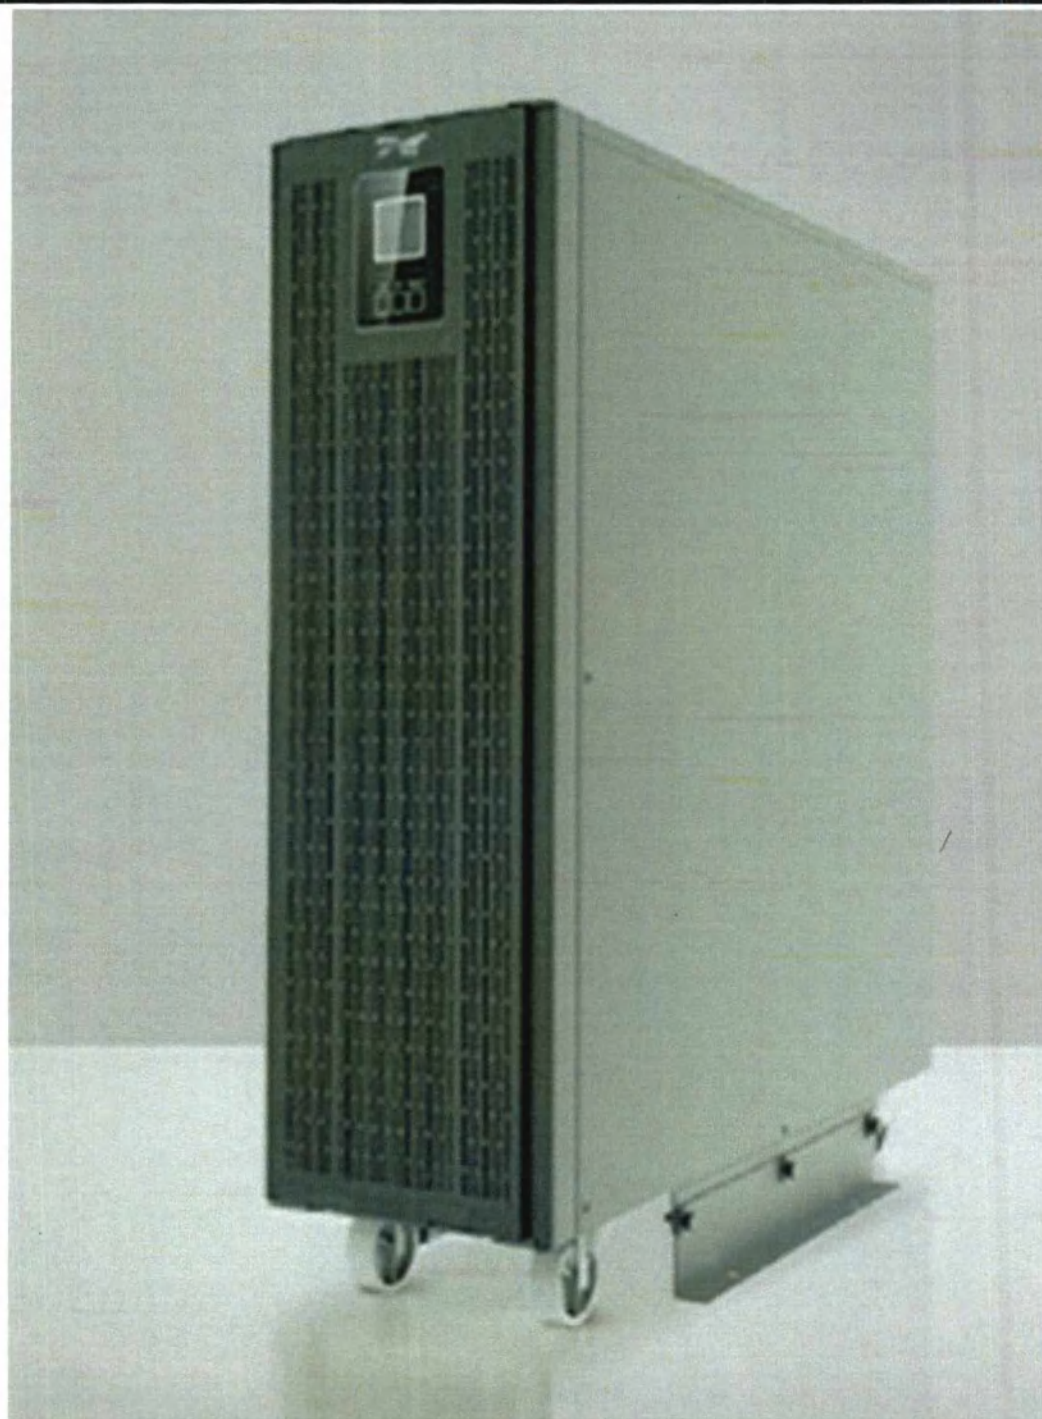



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

_____ листах

