


ФОТО

**Анализатор автоматический биохимический ВА200
для in vitro диагностики с принадлежностями**


Русский язык

 **BioSystems**


1. Внешний вид анализатора

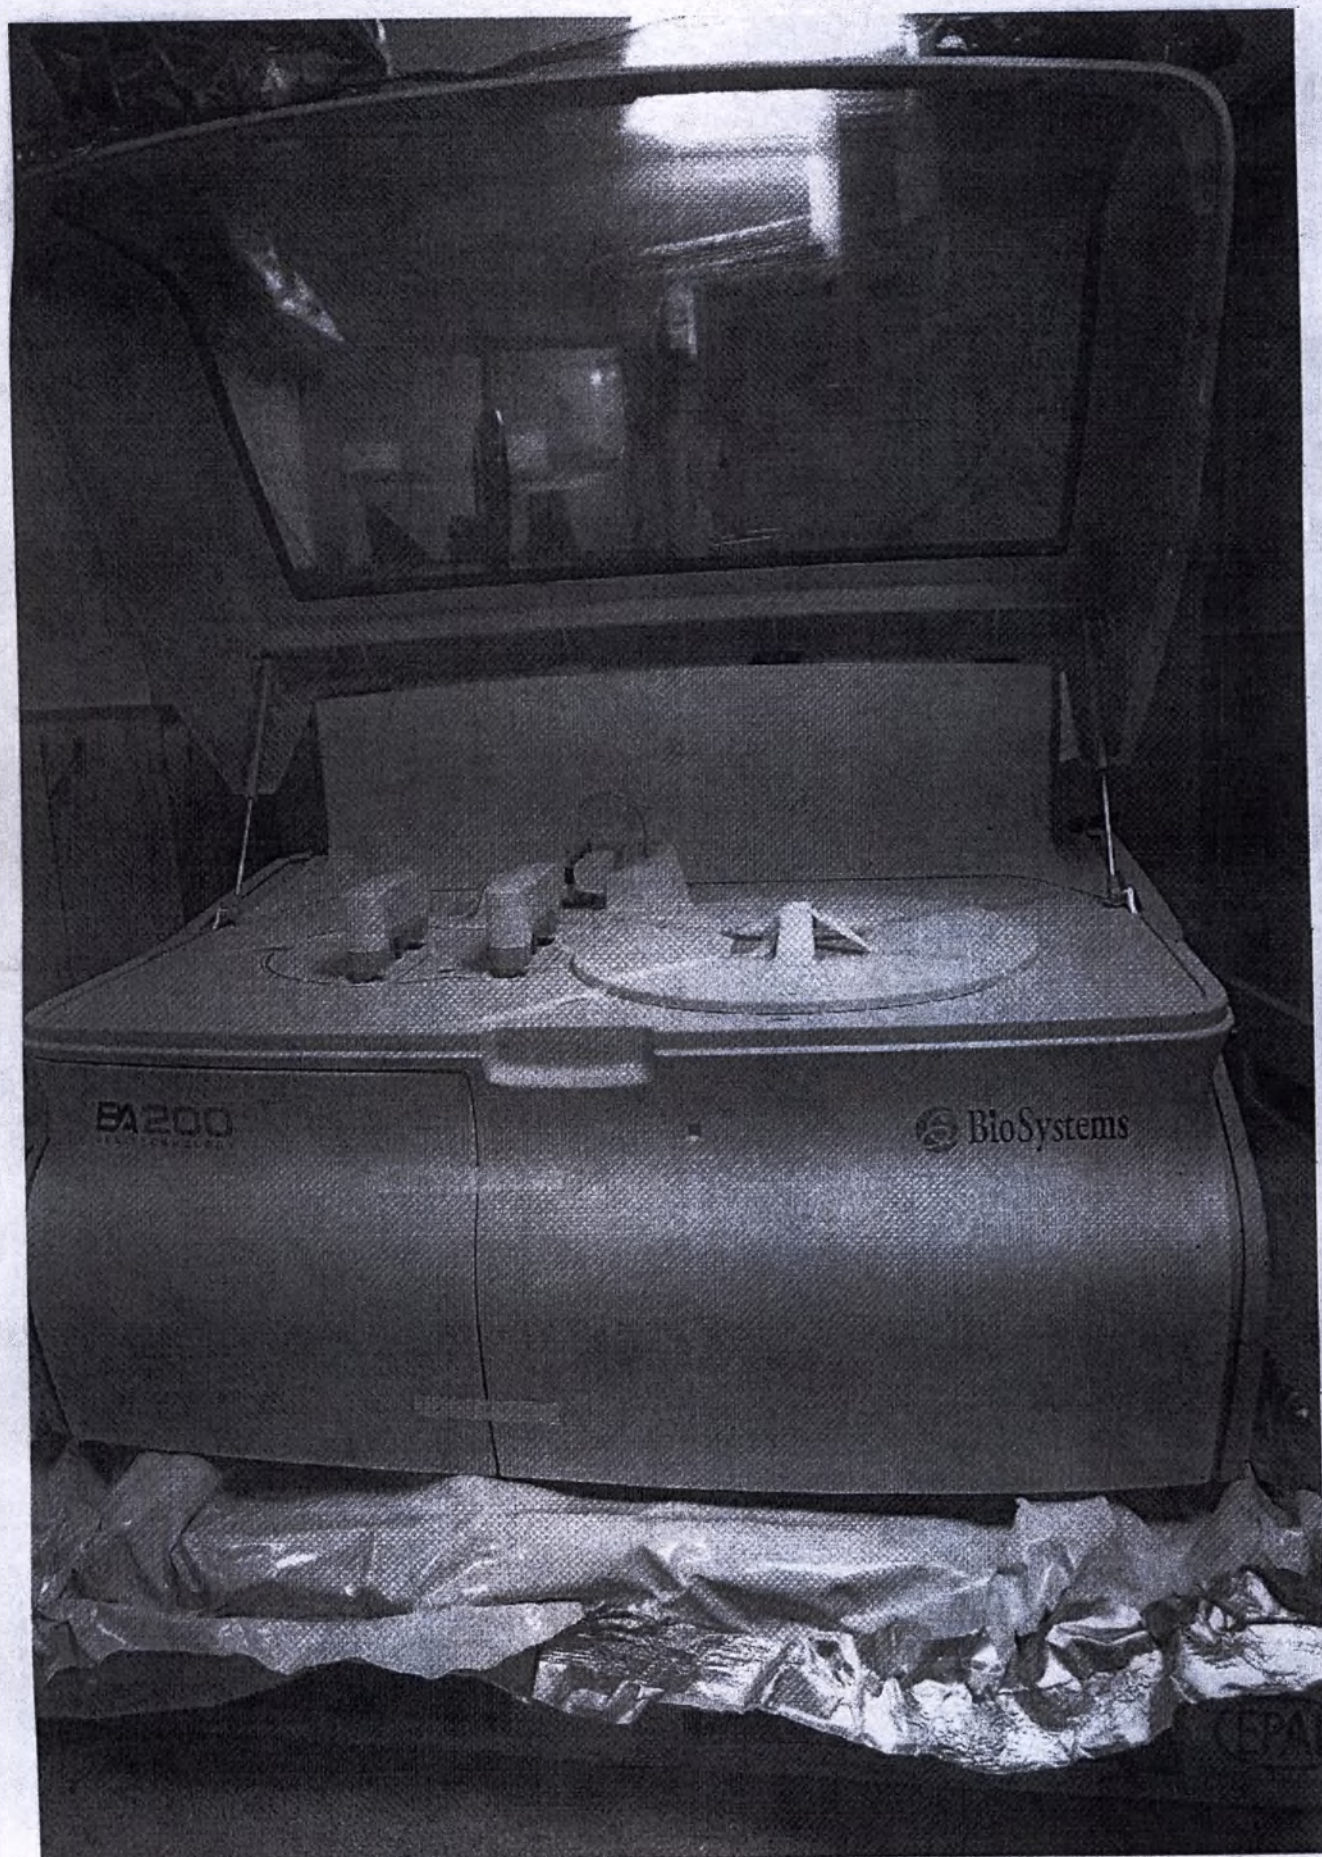

2. Реагентный флакон емкостью 20 мл с крышкой (до 10 шт.).

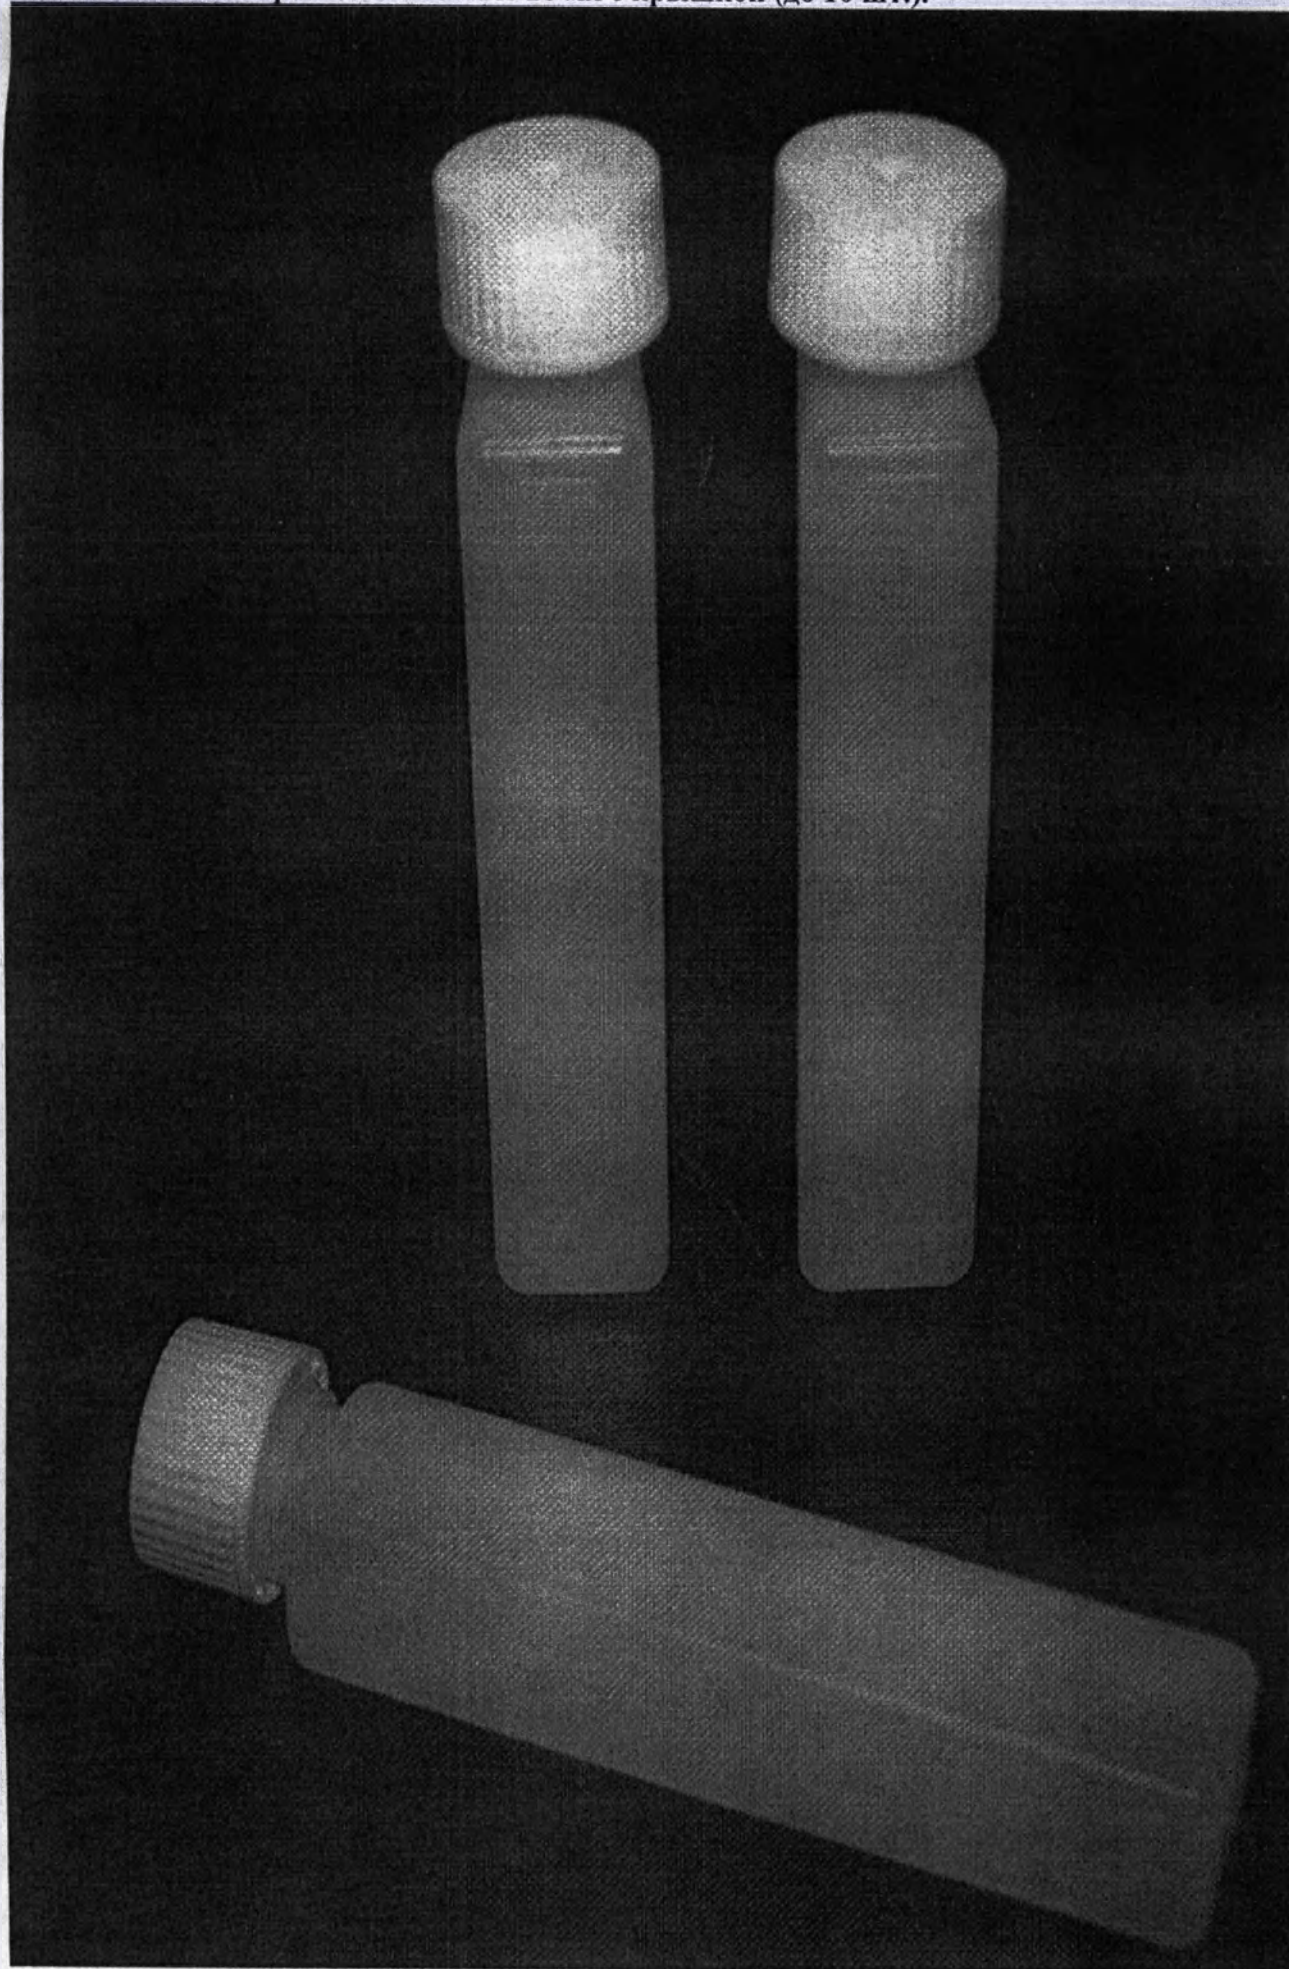


3. Реагентный флакон емкостью 60 мл с крышкой (до 20 шт.).

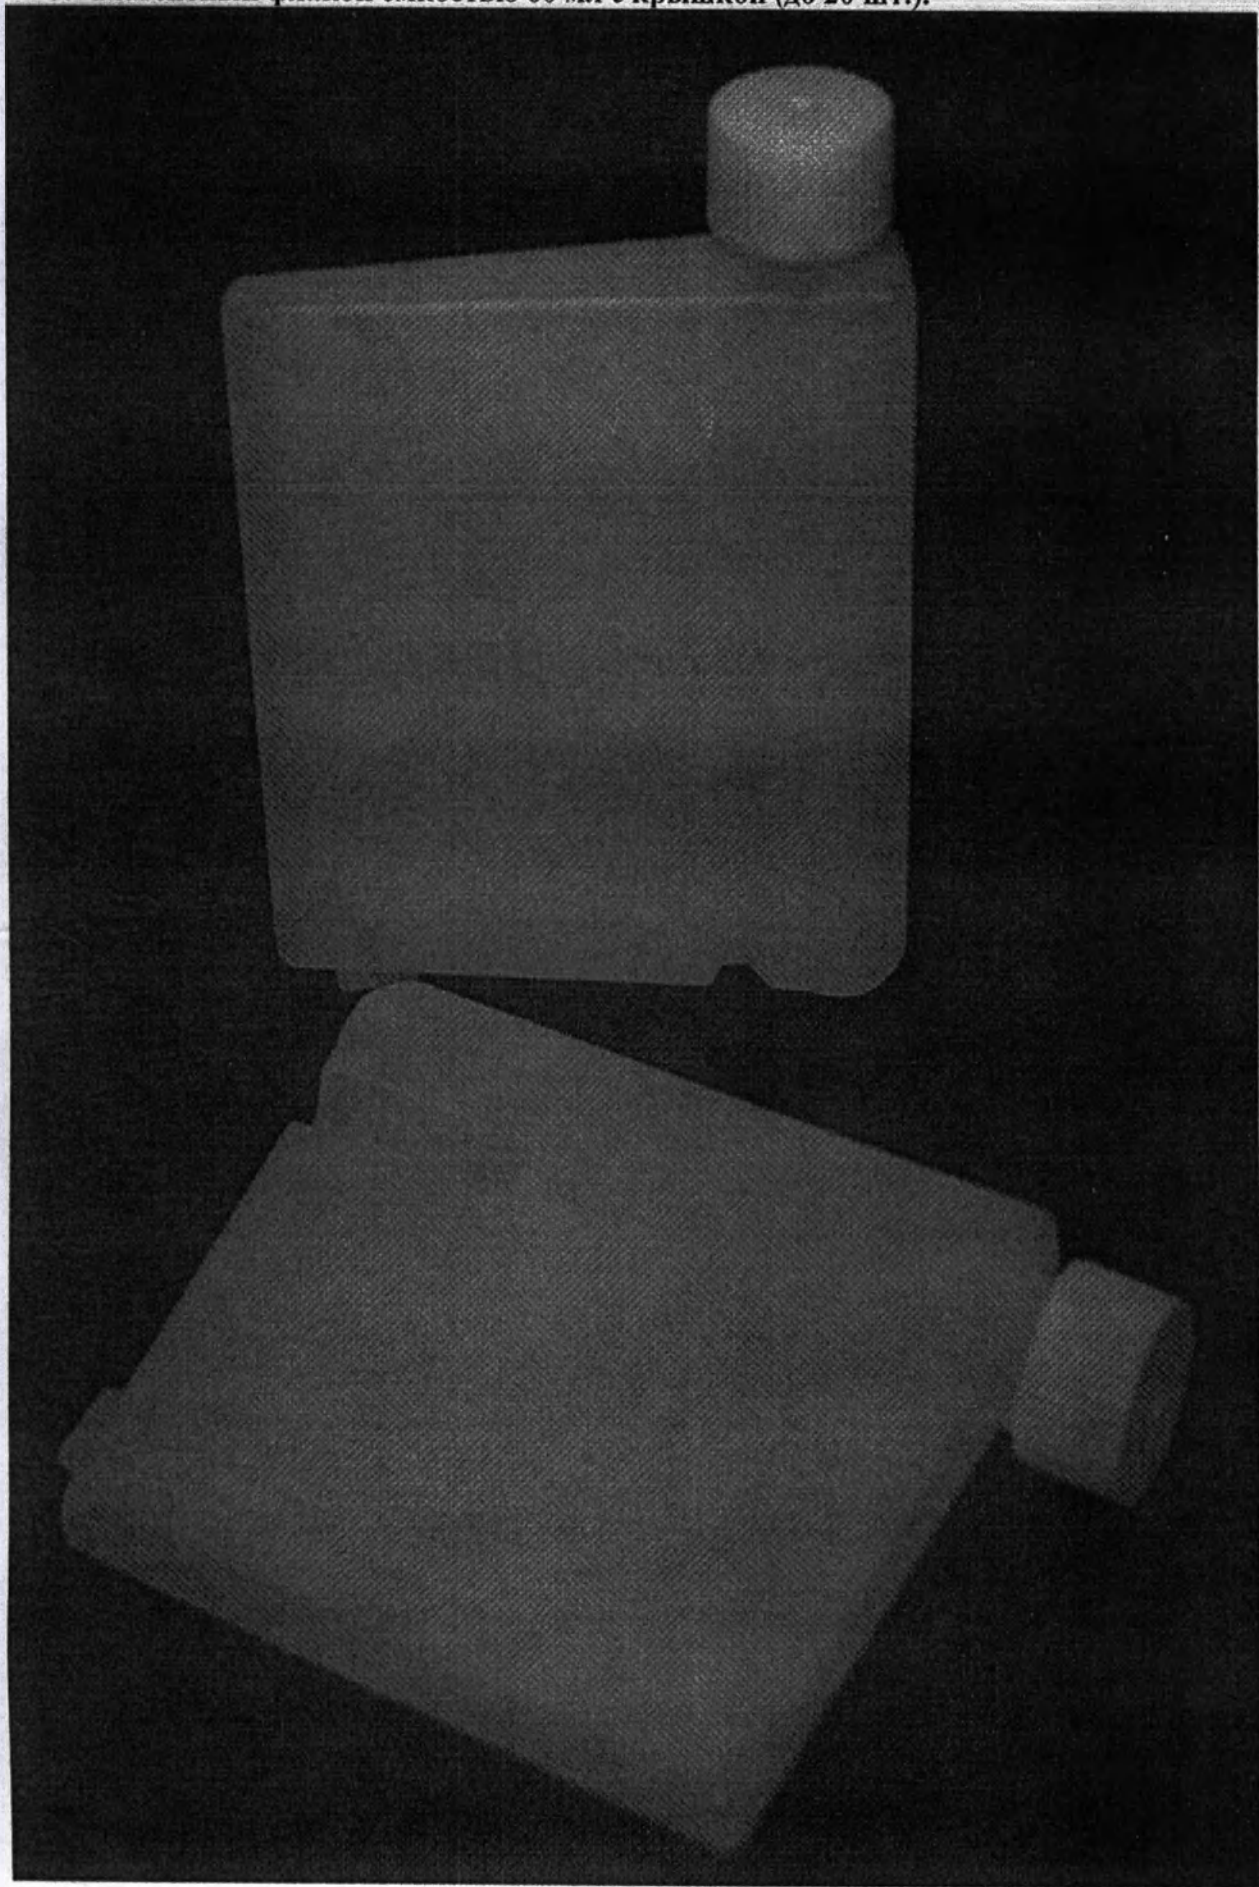


4. Наклейки для бутылочек с штрих-кодом (до 1 000 шт.).




5. Реакционный ротор (до 10 шт.).

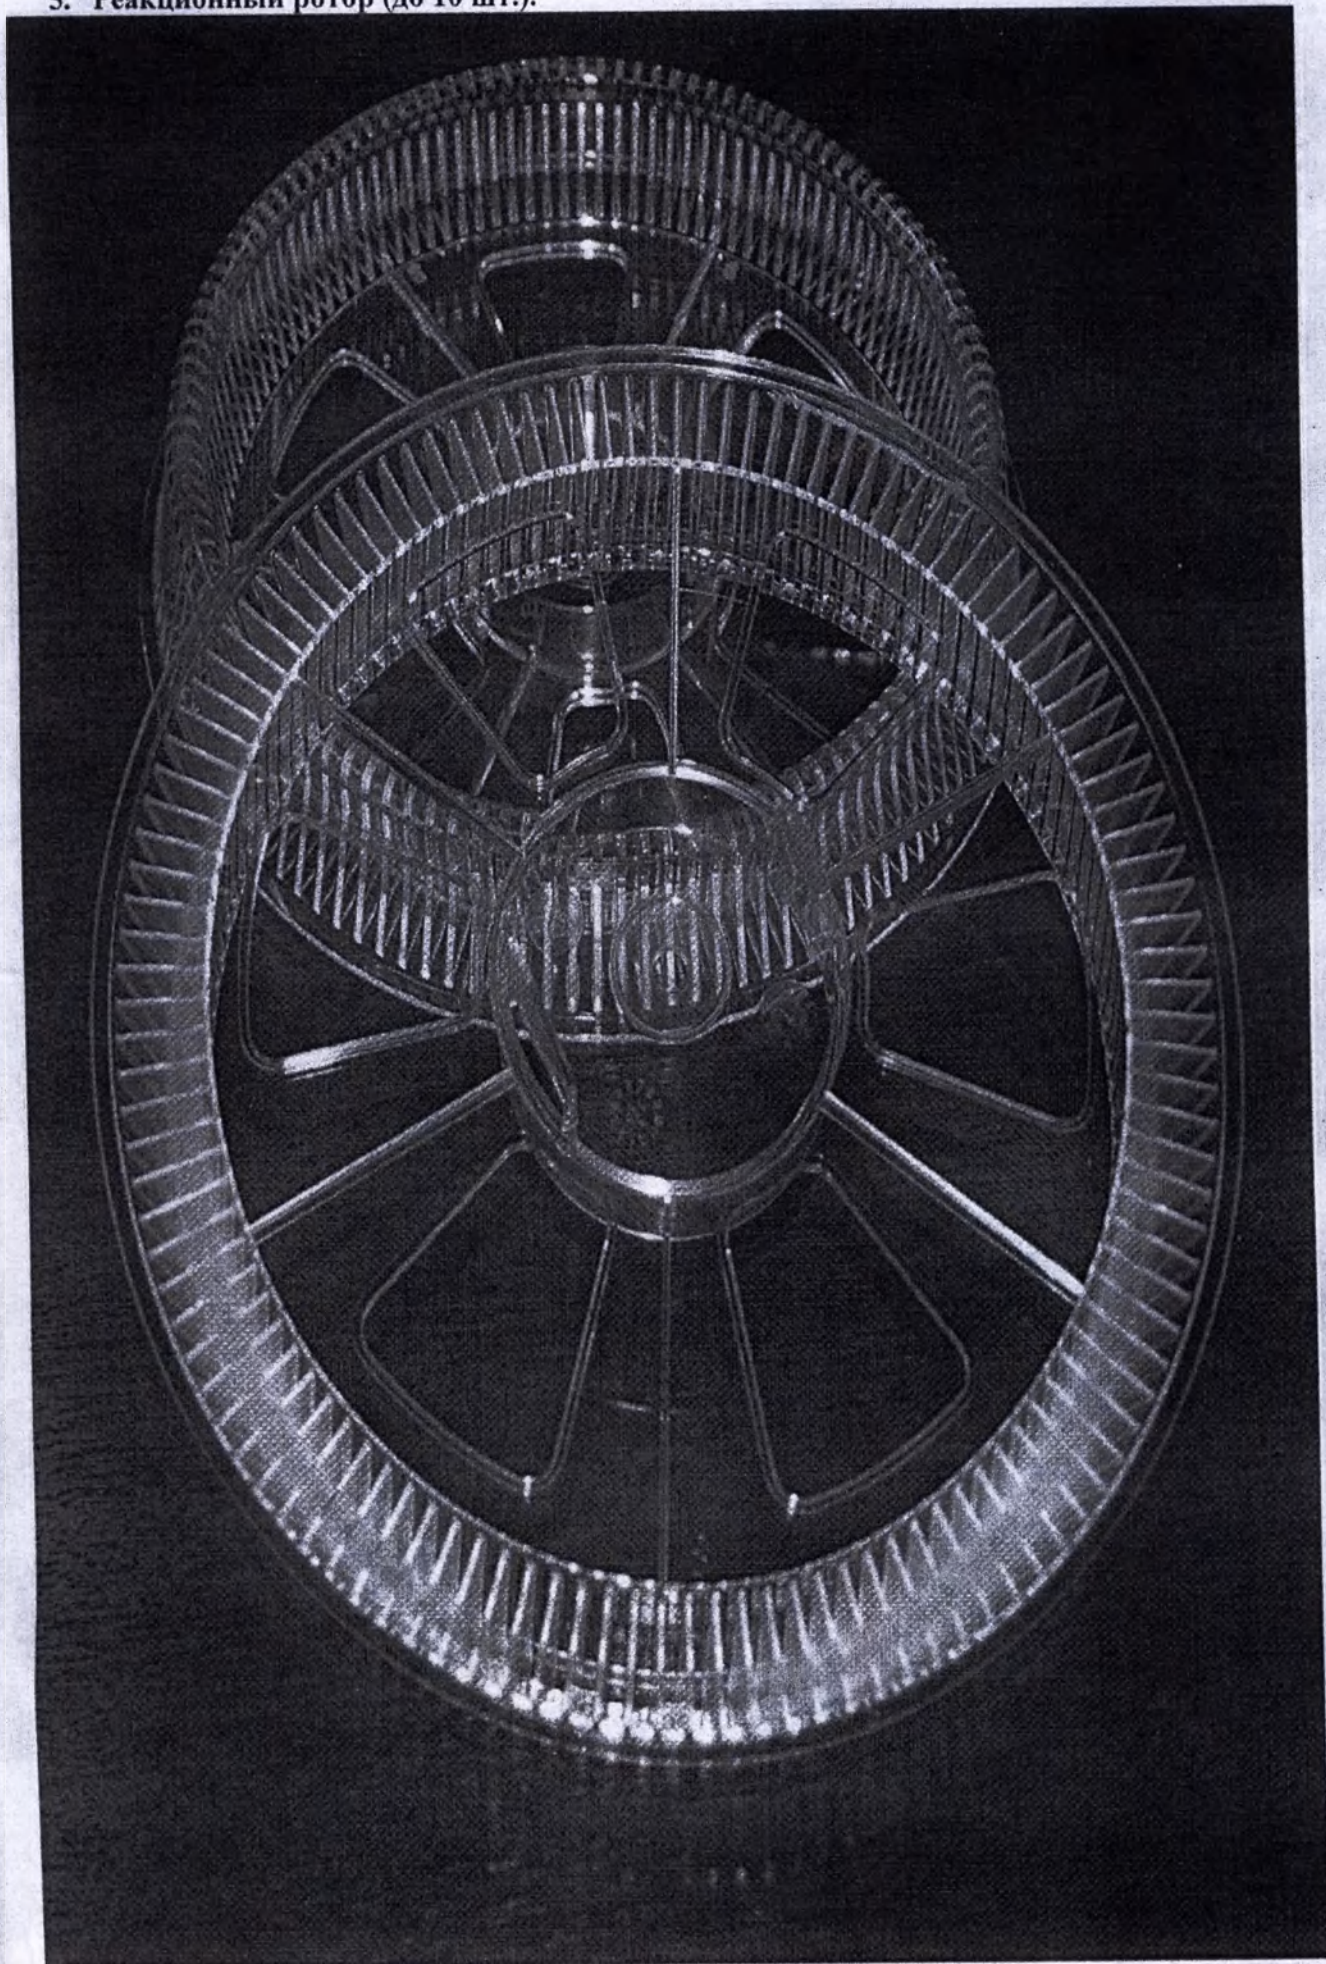


6. Ротор для реагентов и образцов (1 шт.)

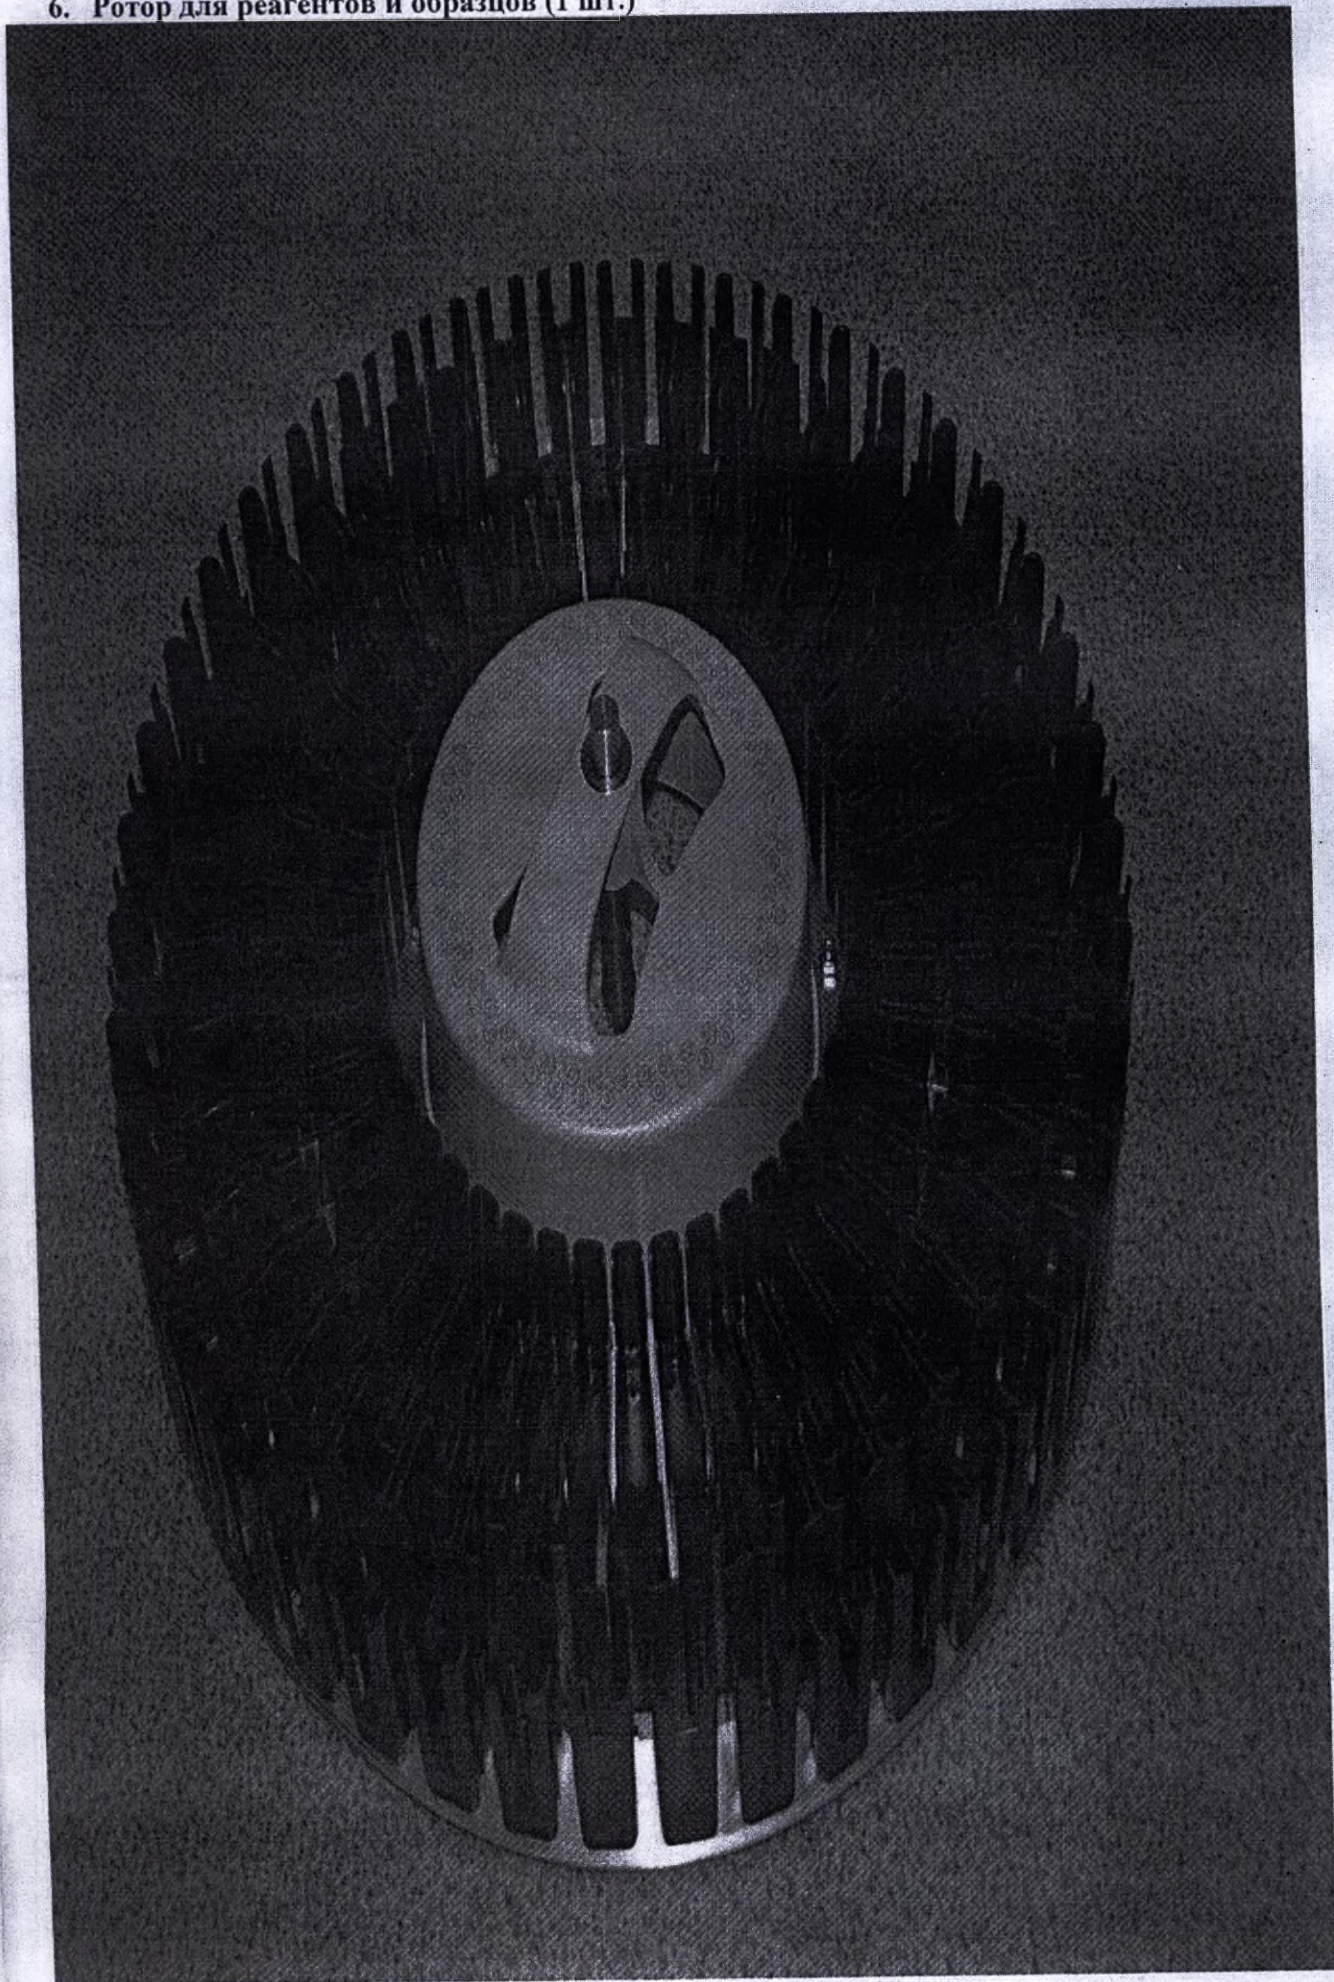


7. Пробирки педиатрические (до 1000 шт.).

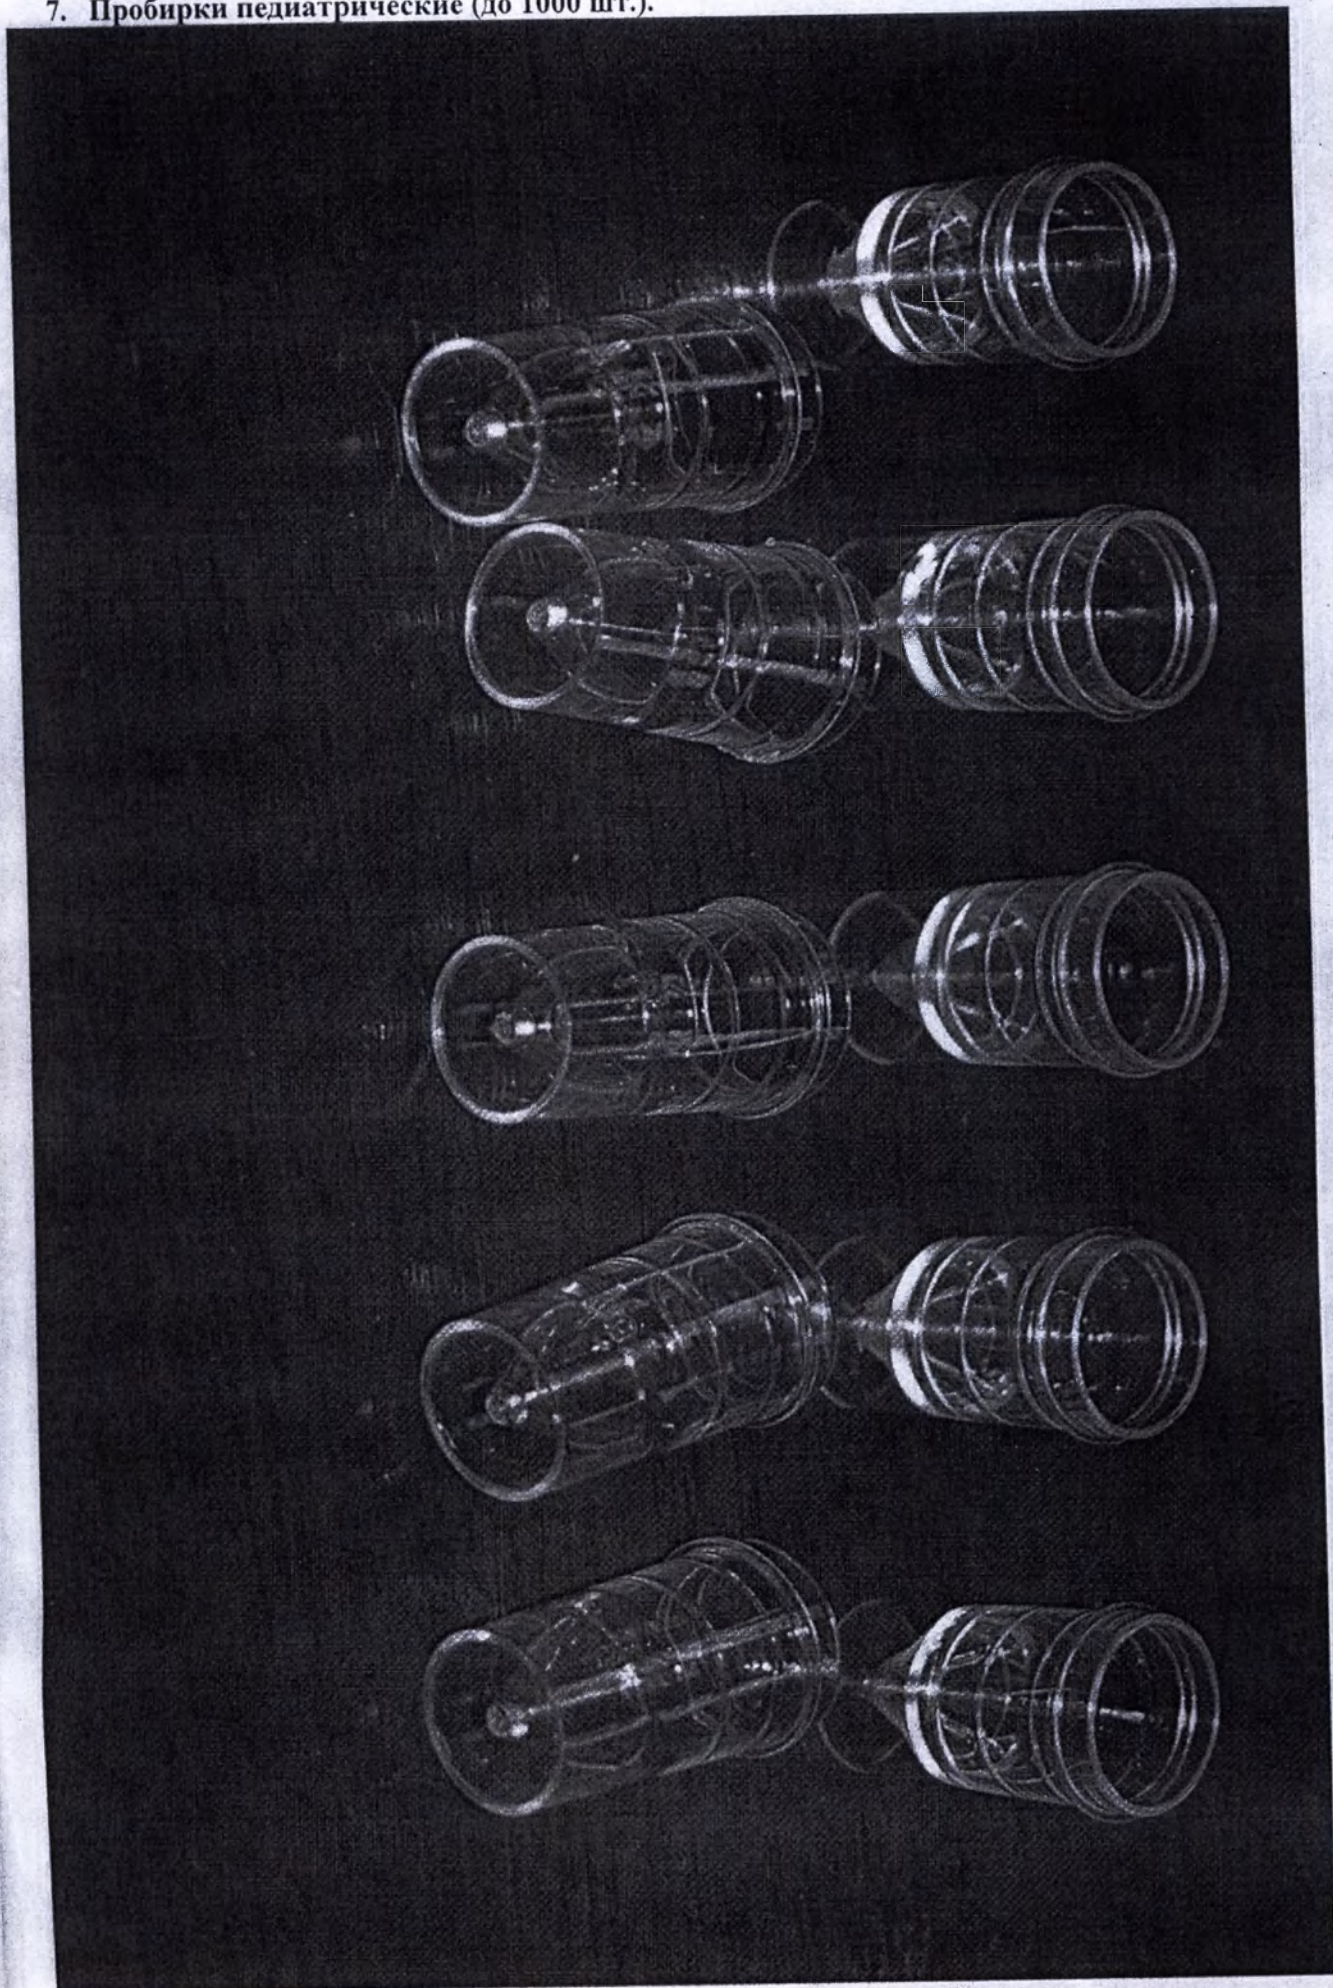


8. Бутылка концентрата моющего раствора емкостью 500 мл (1 шт.).

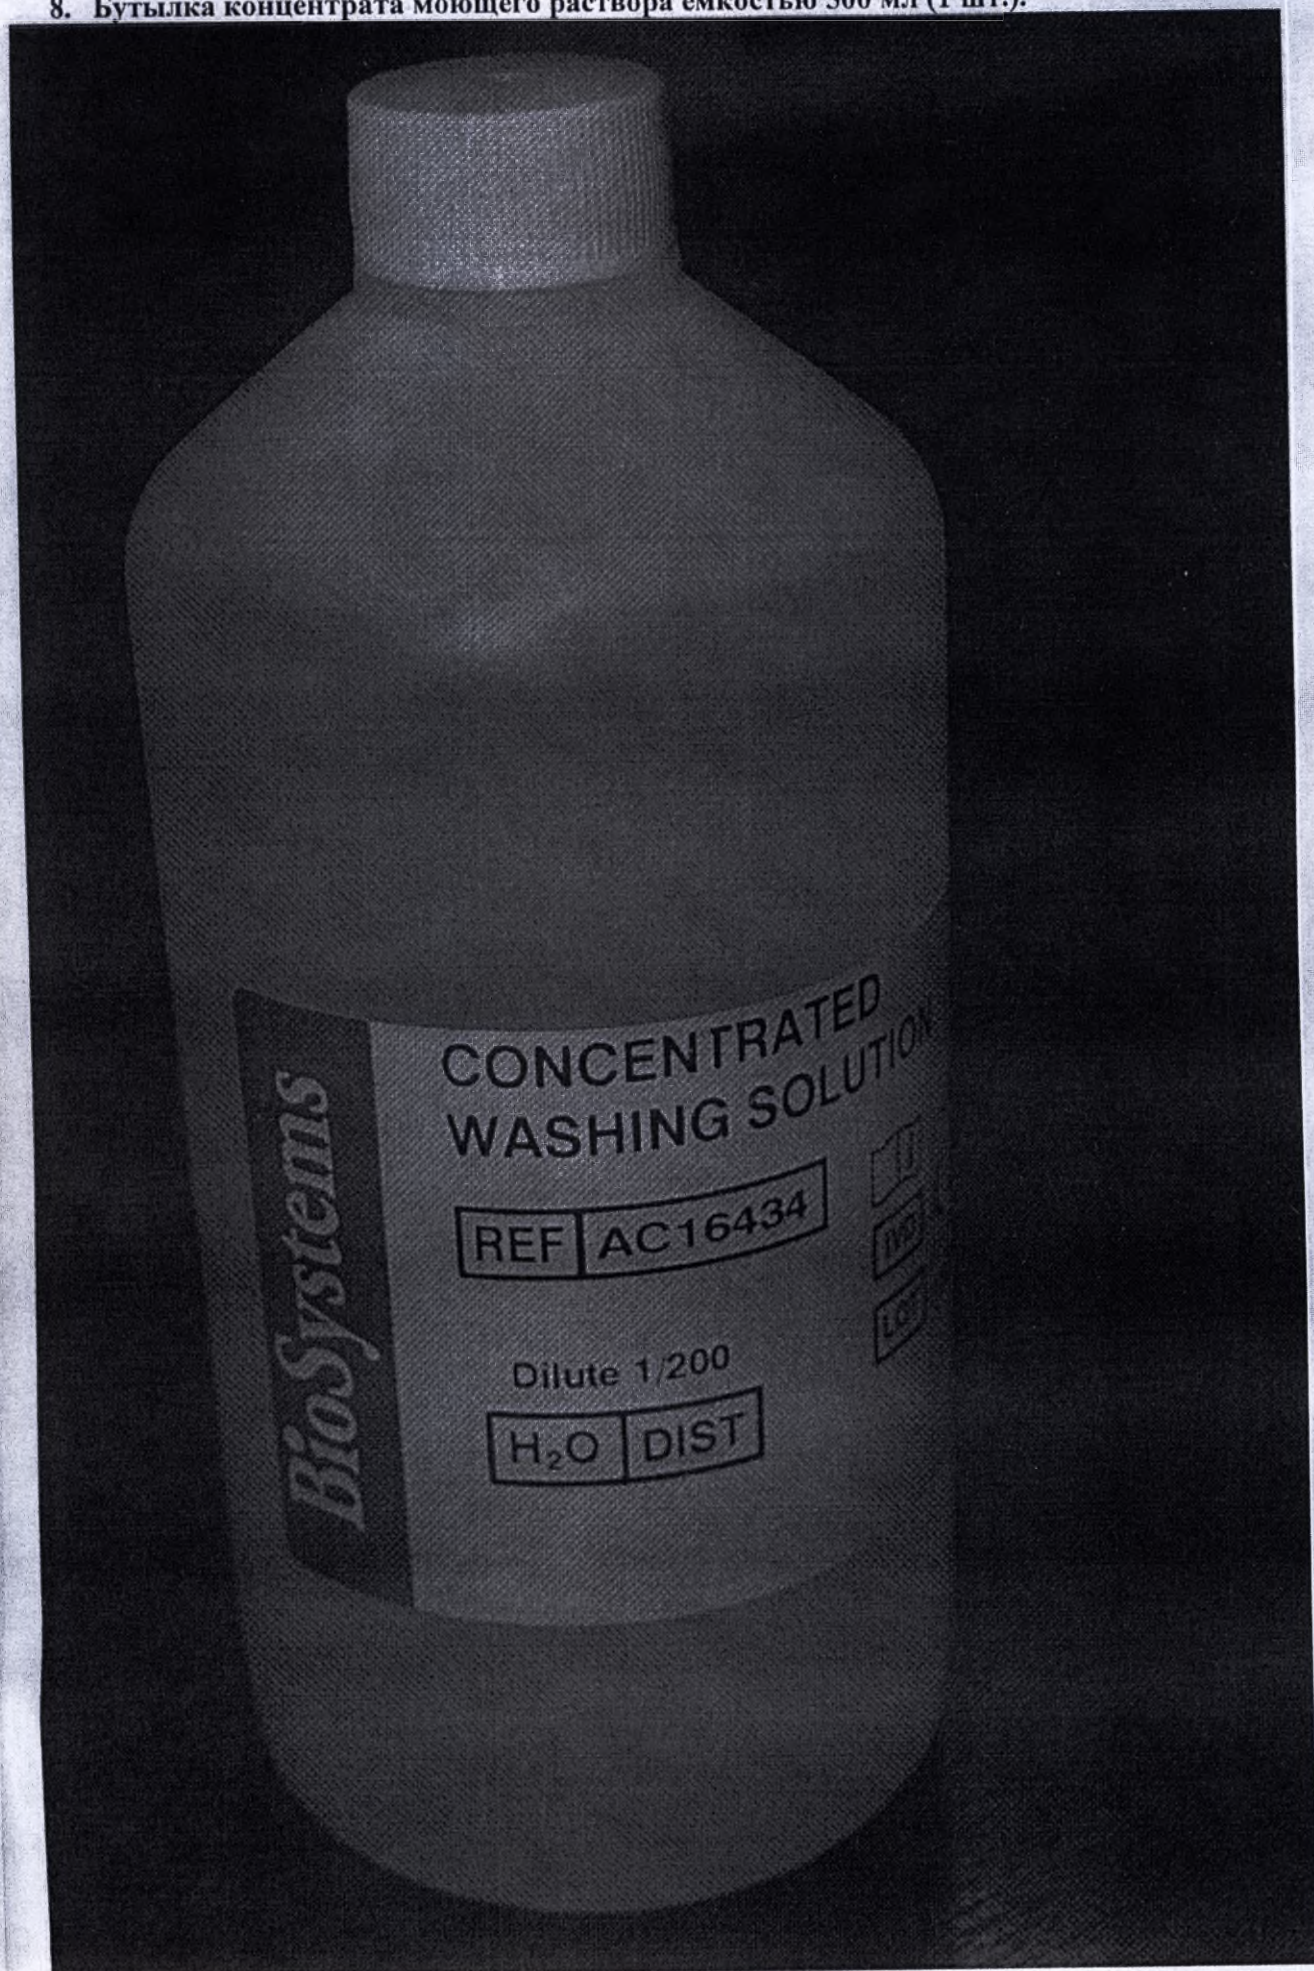


9. Бутылочка с кислотным промывочным раствором емкостью 20 мл (до 5 шт.).

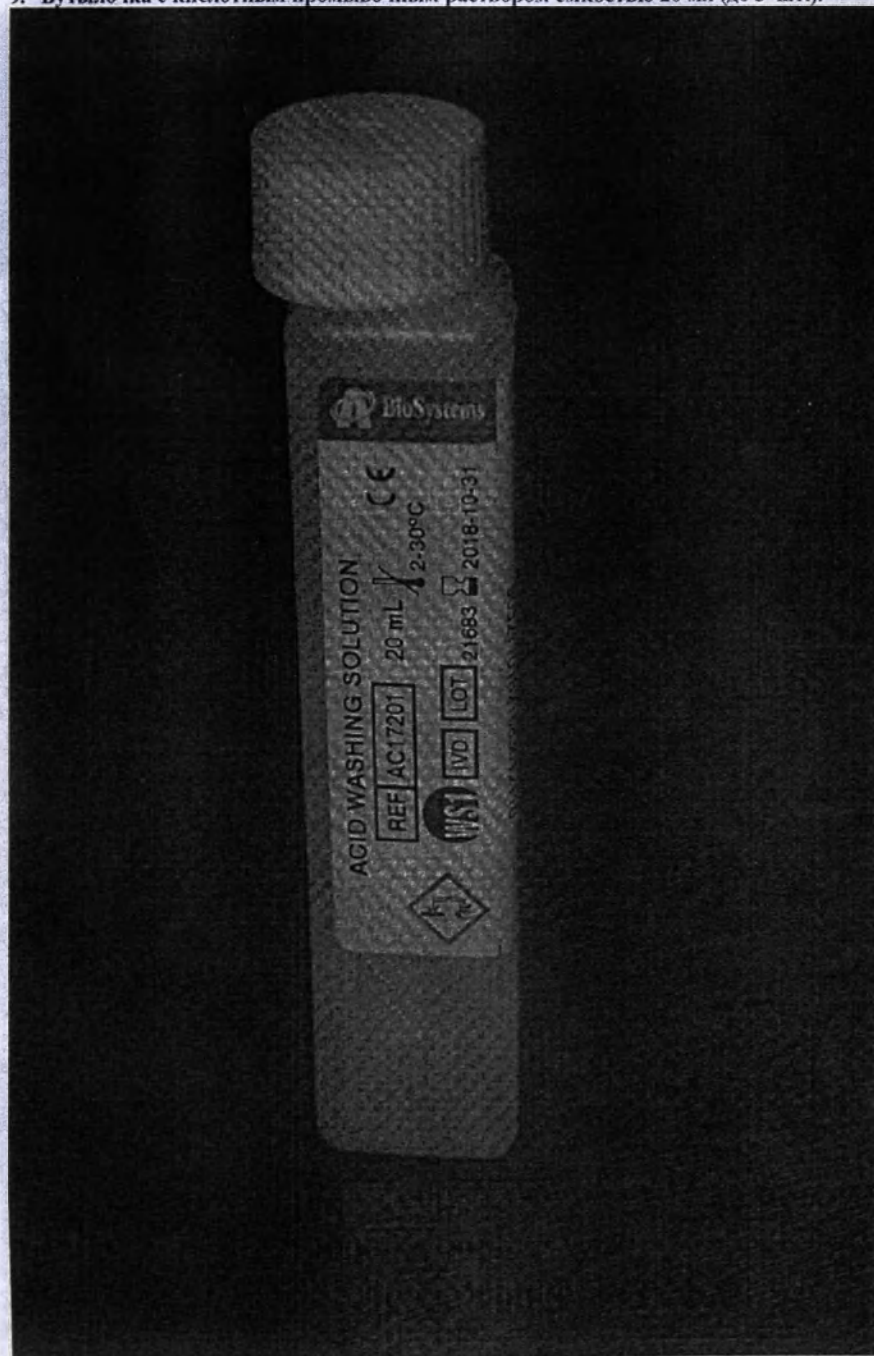


10. Бутылочка с щелочным промывочным раствором емкостью 15 мл (до 4 шт.).

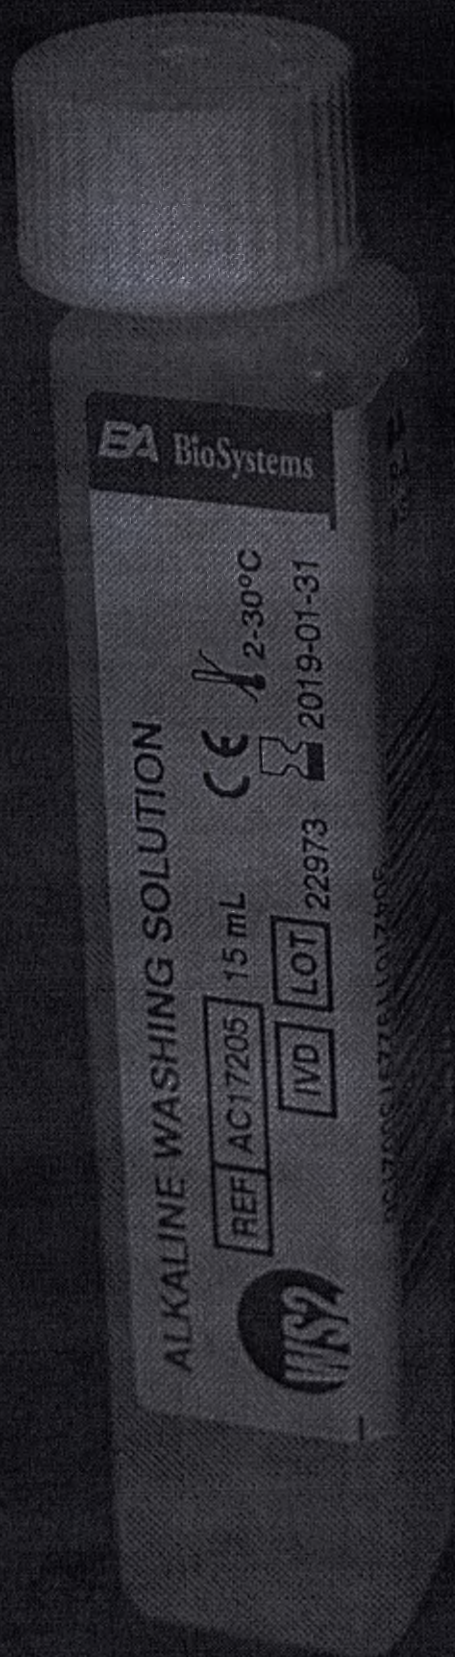


11. Бутылка с моющим раствором емкостью 1000 мл – 1 шт.

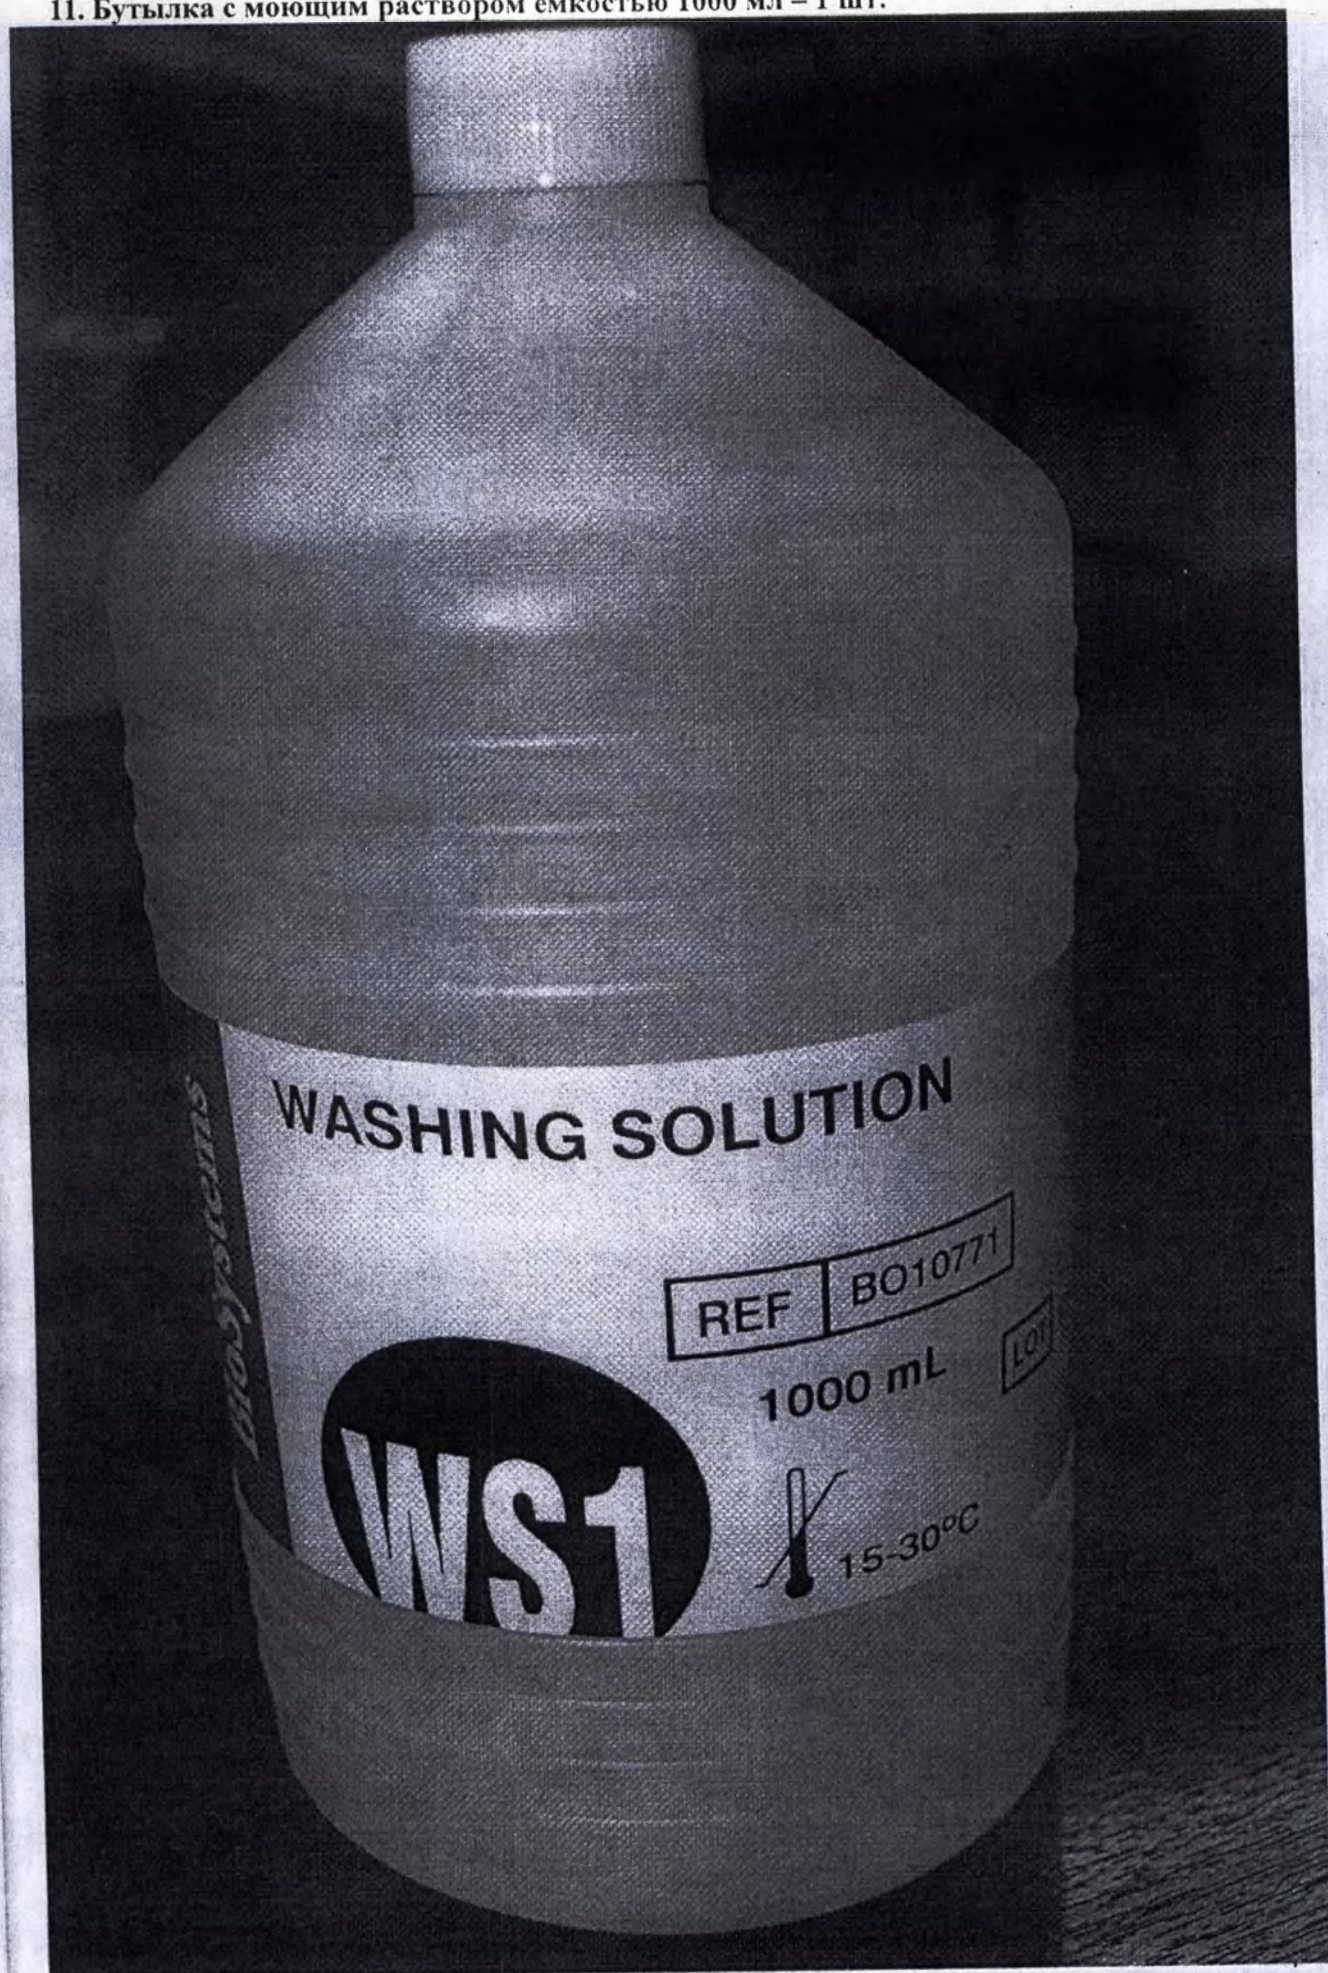


12. Адаптеры для педиатрических пробирок (до 100 шт.).

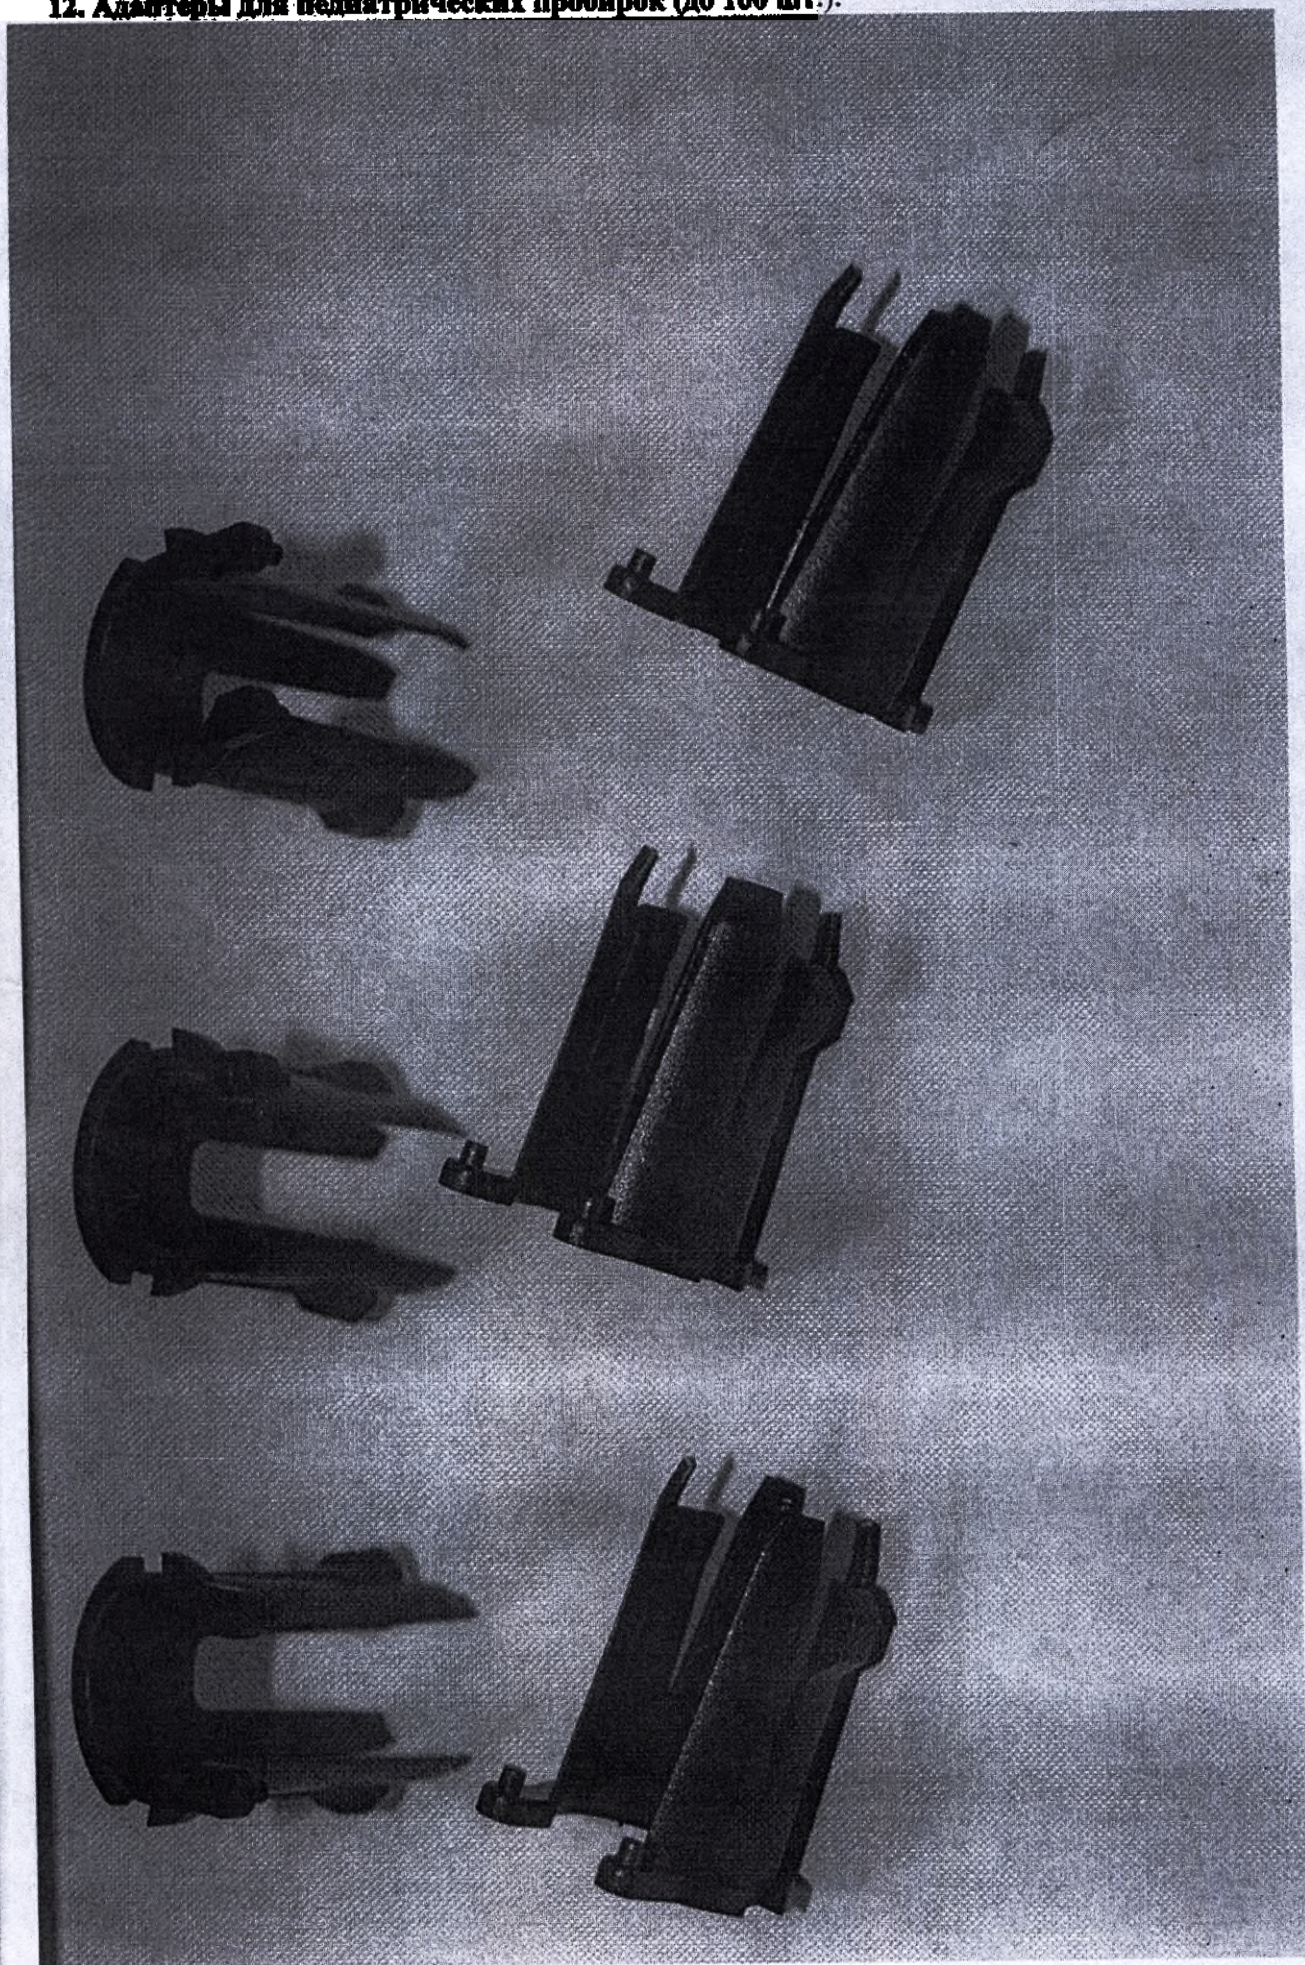


13. Адаптеры для пробирок (до 100 шт.).

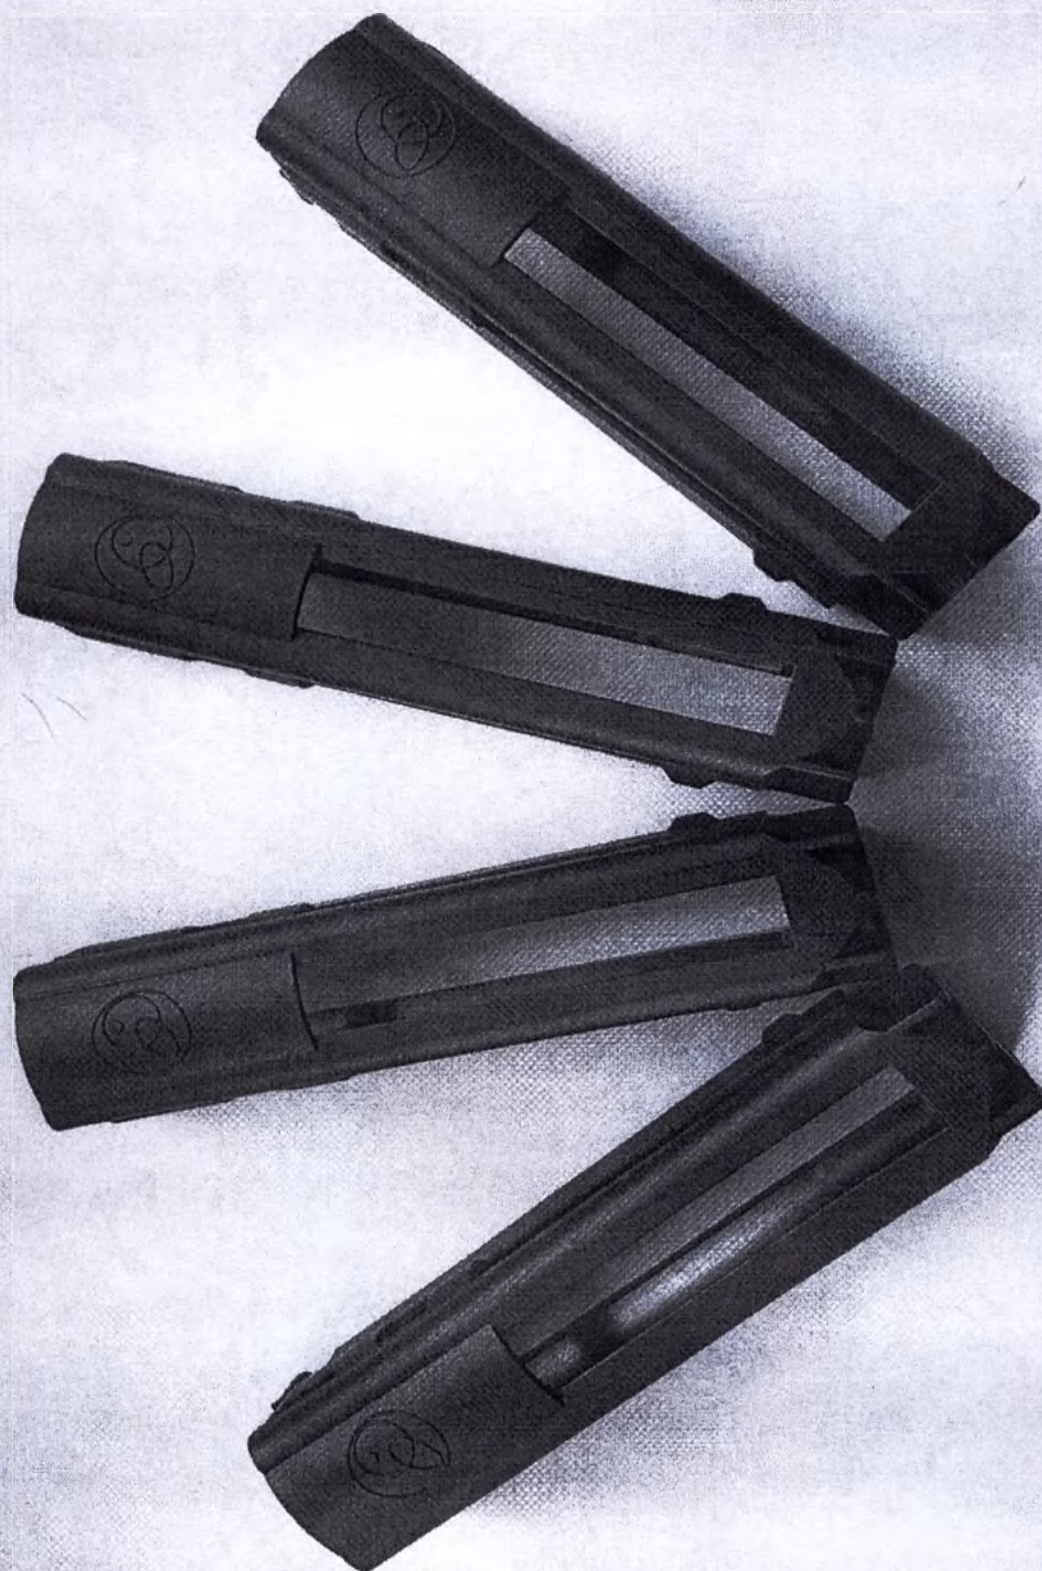


14. DVD –диск с программным обеспечением и руководством пользователя в PDF-формате (1 шт.).

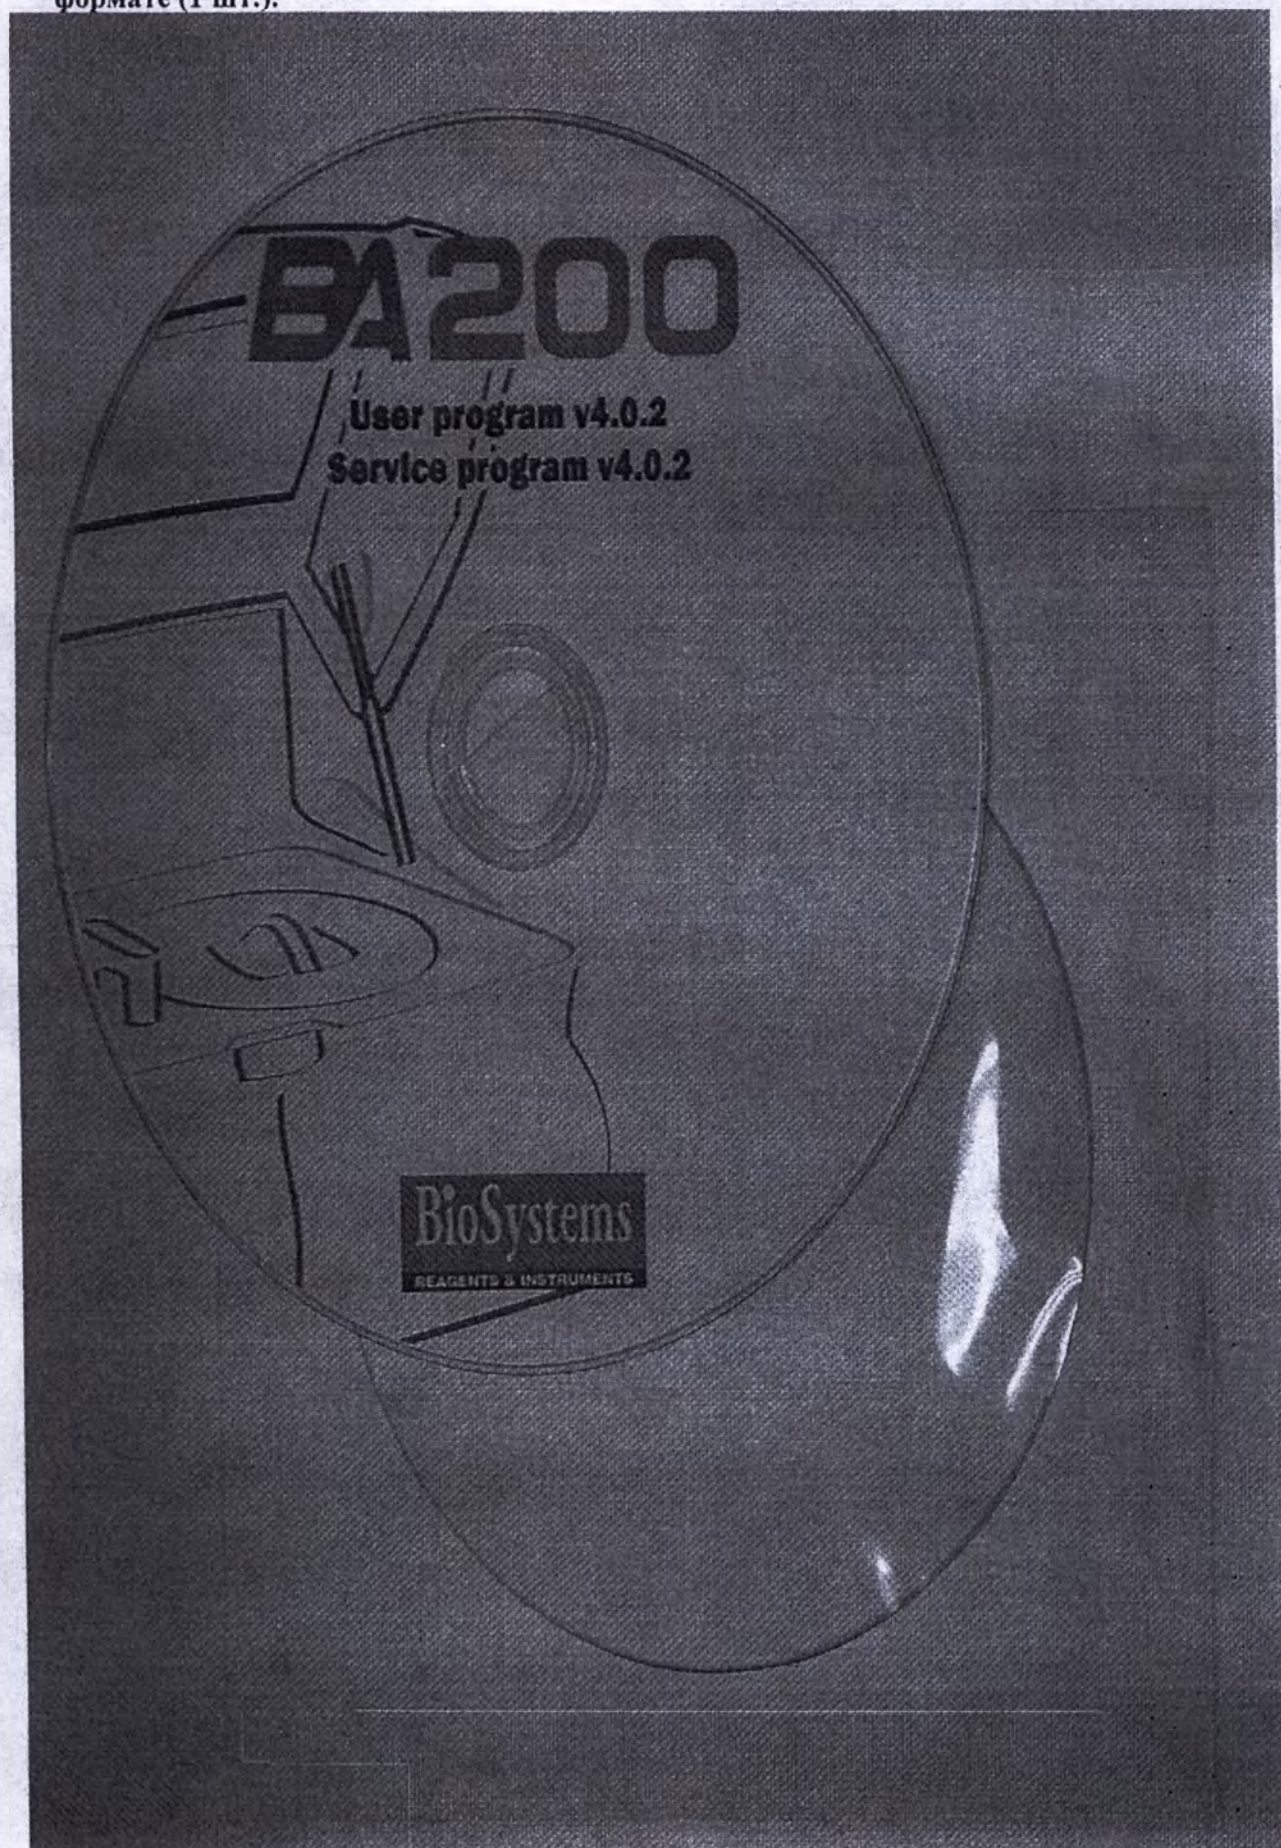


15. Кабель соединительный USB – 1 шт.

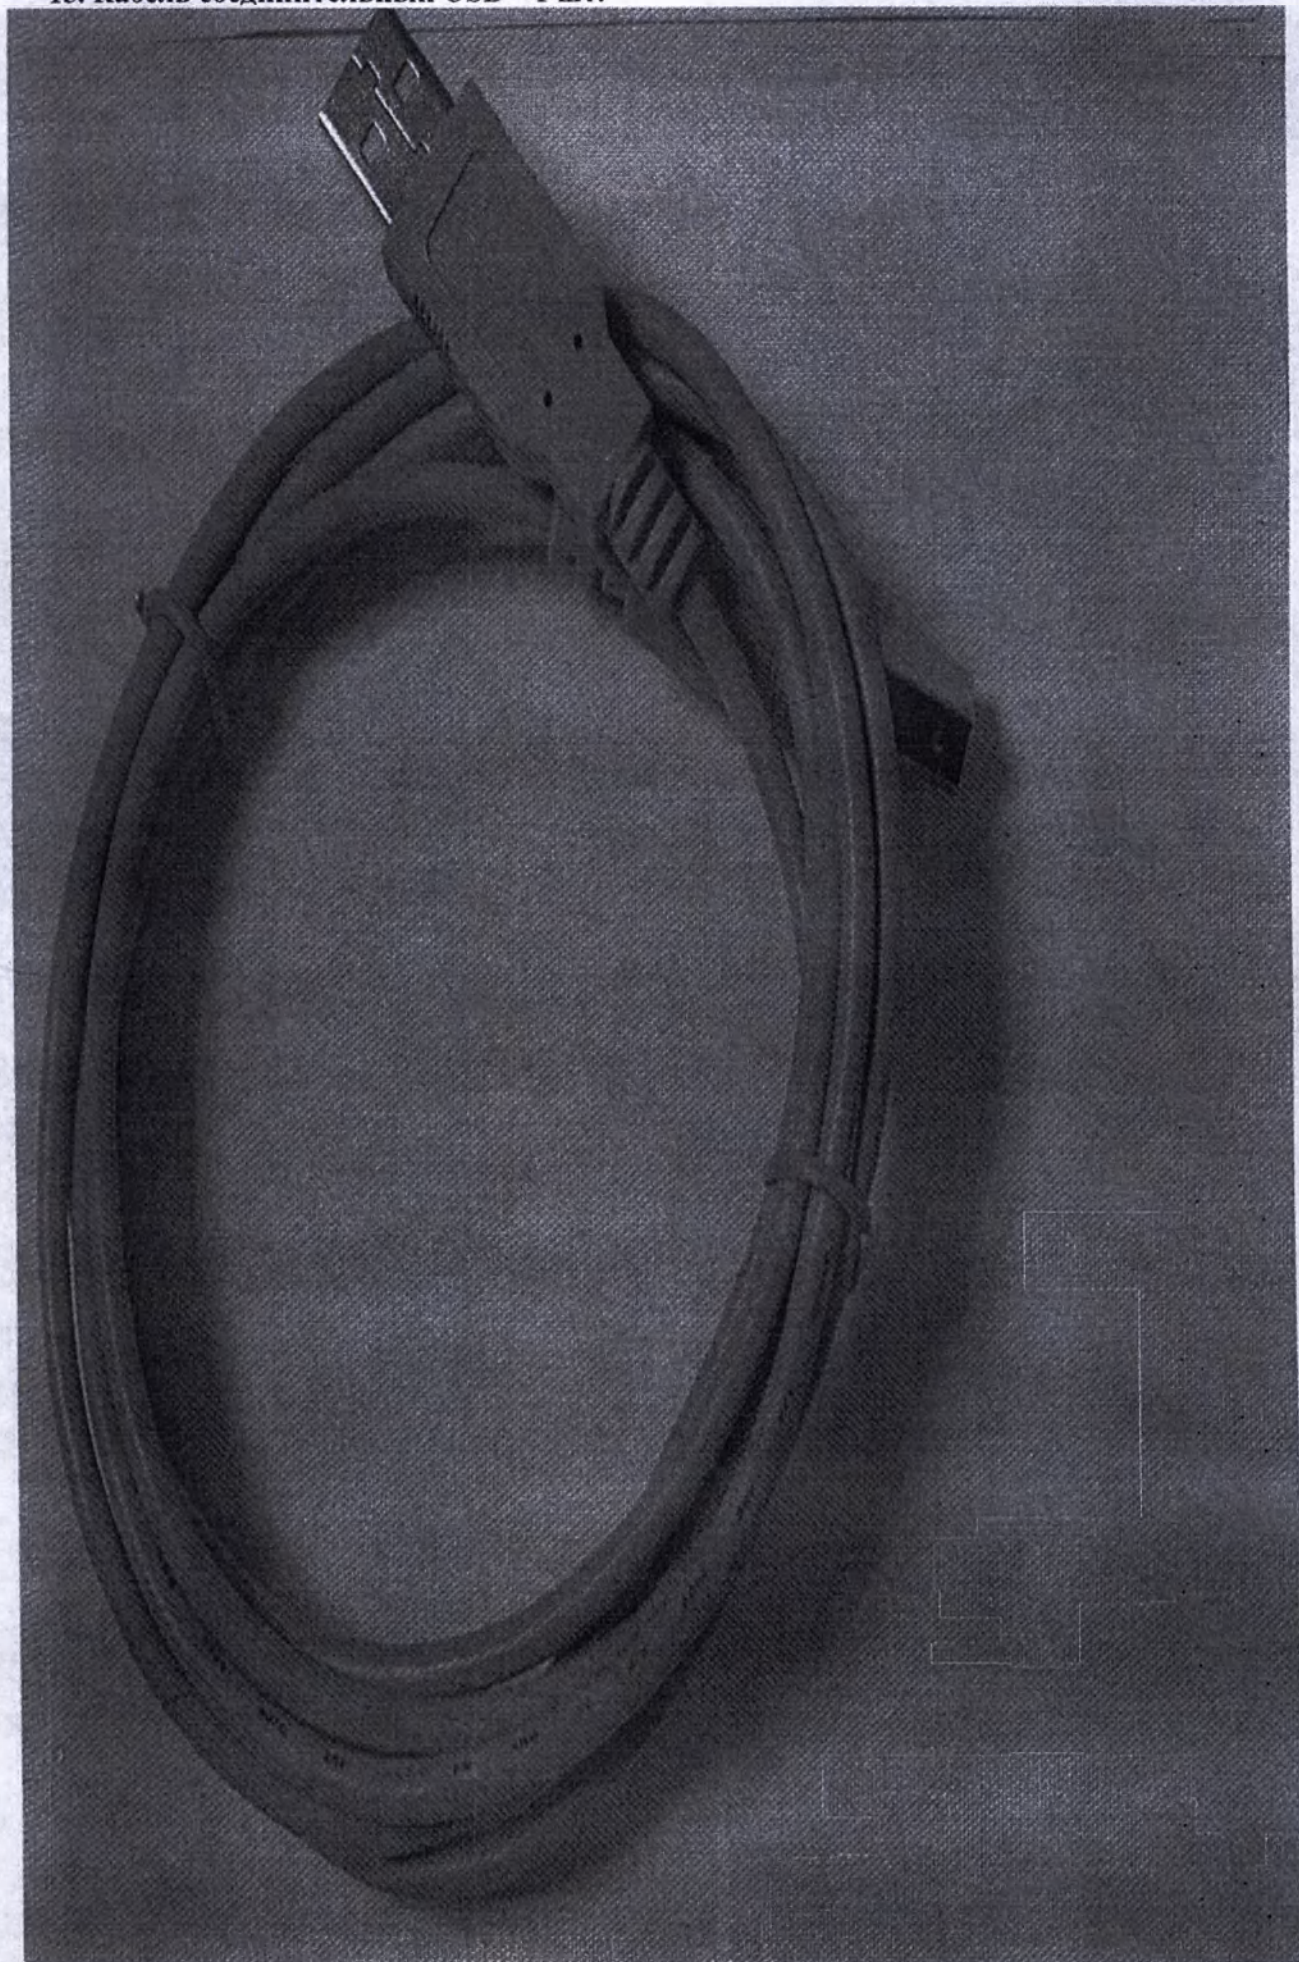


16. Сетевой кабель для подключения к сети питания (евро вариант) (1 шт.).

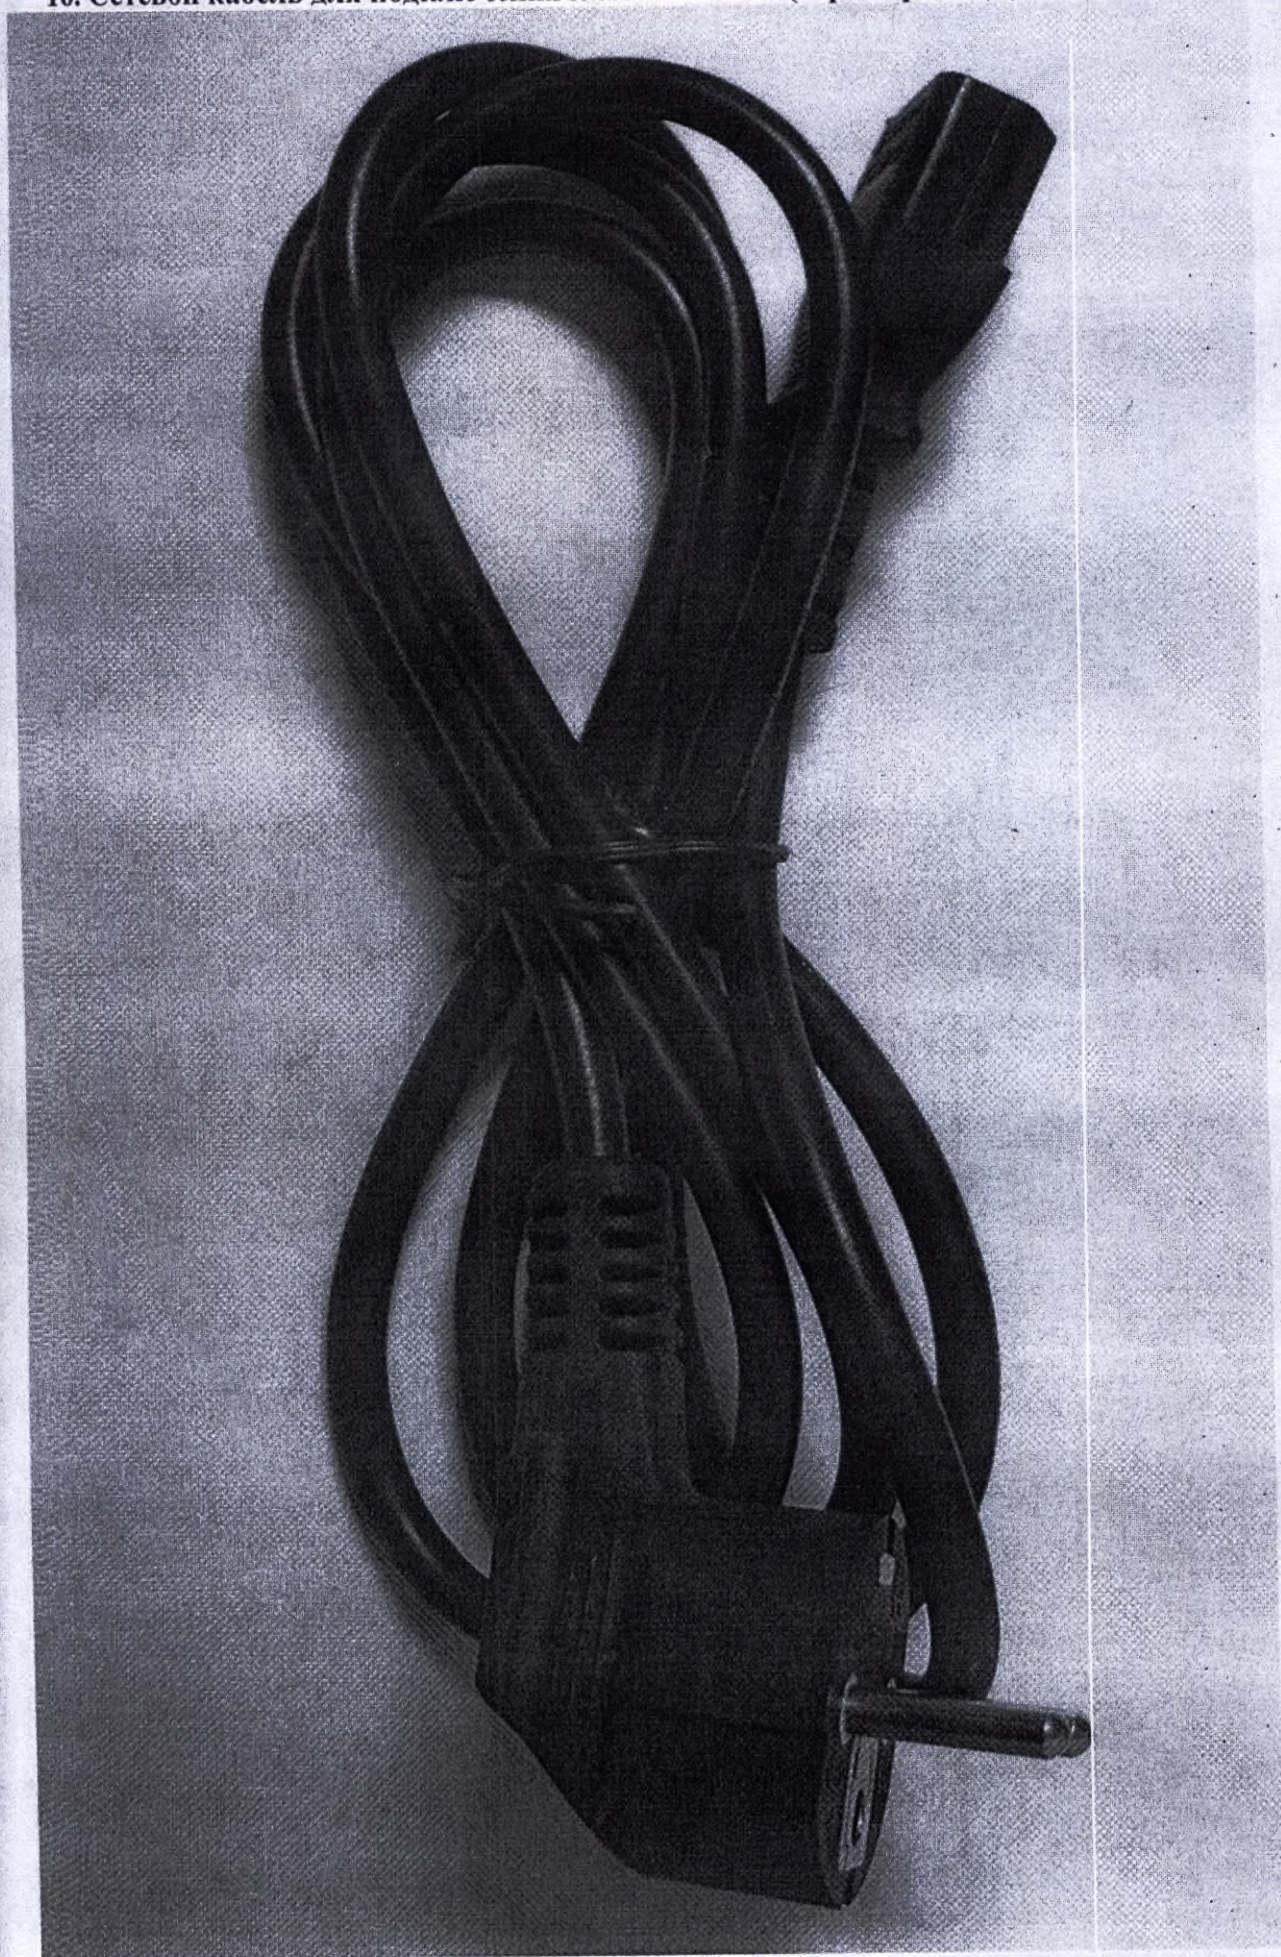


17. Сетевой кабель для подключения к сети питания (американский вариант) (1 шт.).

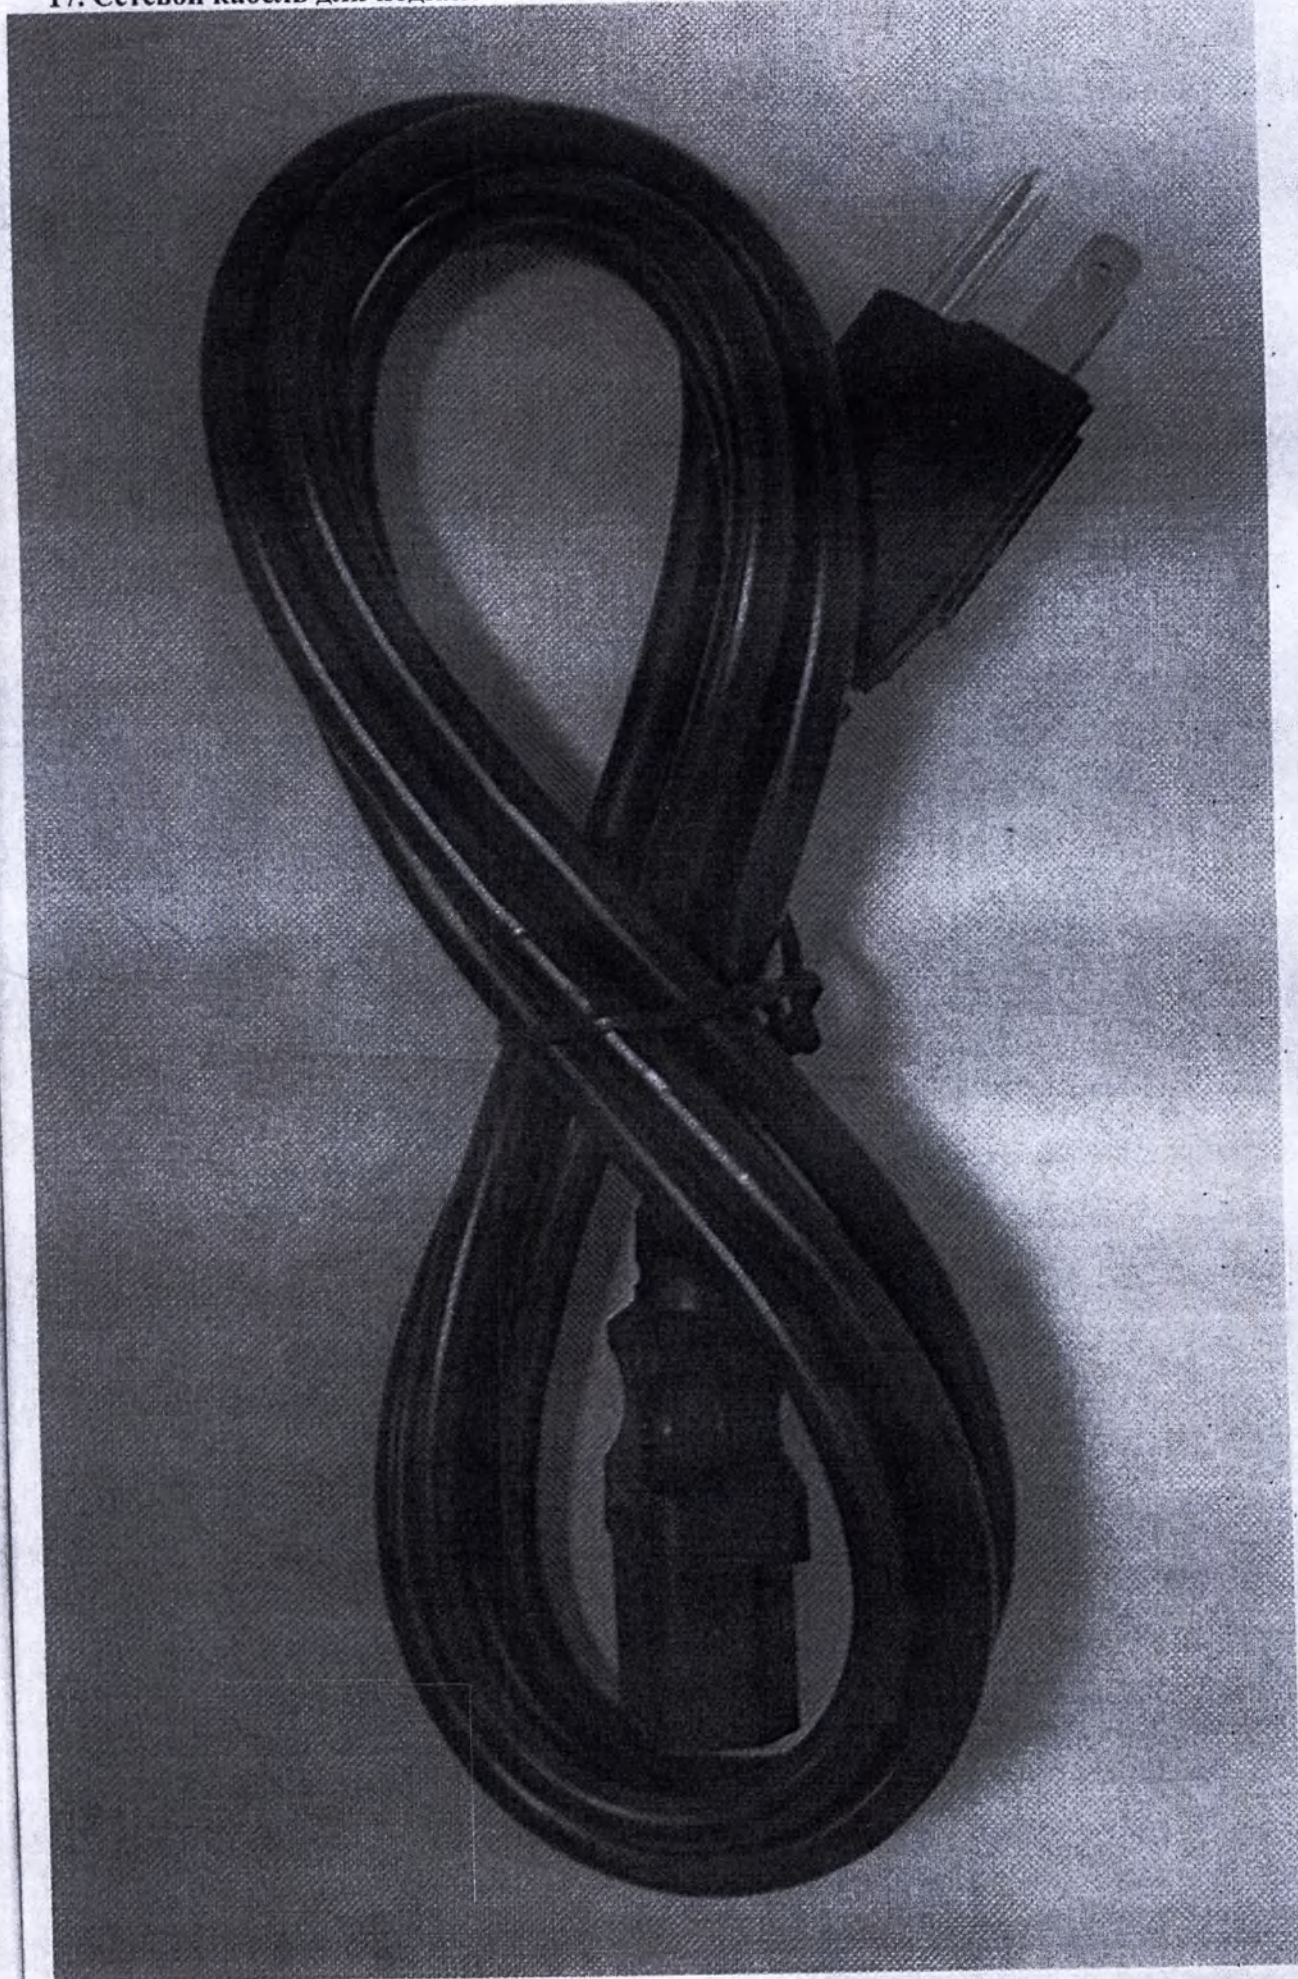


18. Плавкий предохранитель (2 шт.).

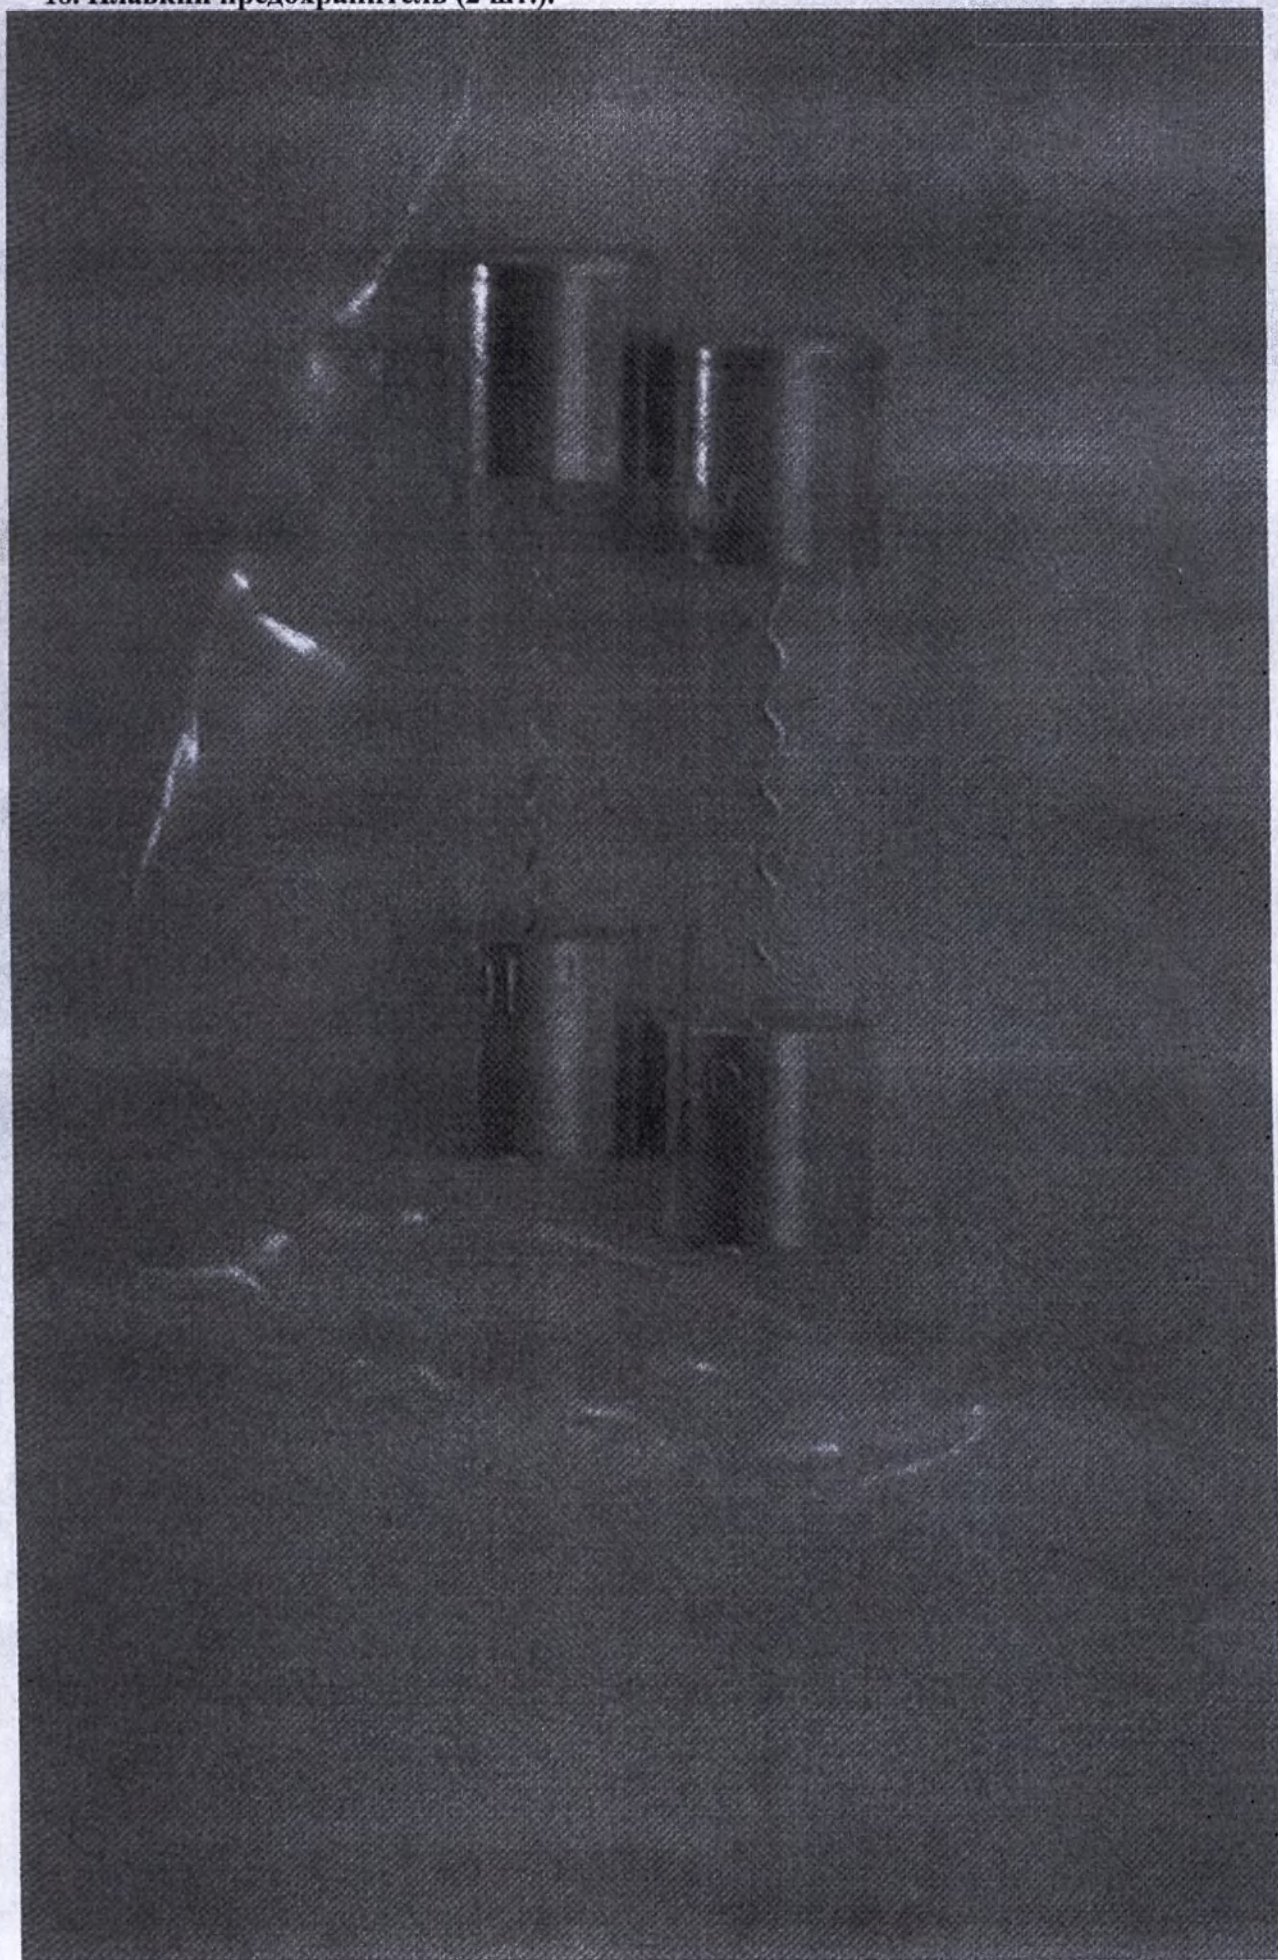


19. Синяя тонкая трубка с фильтрами на концах 3 м (1 шт.)

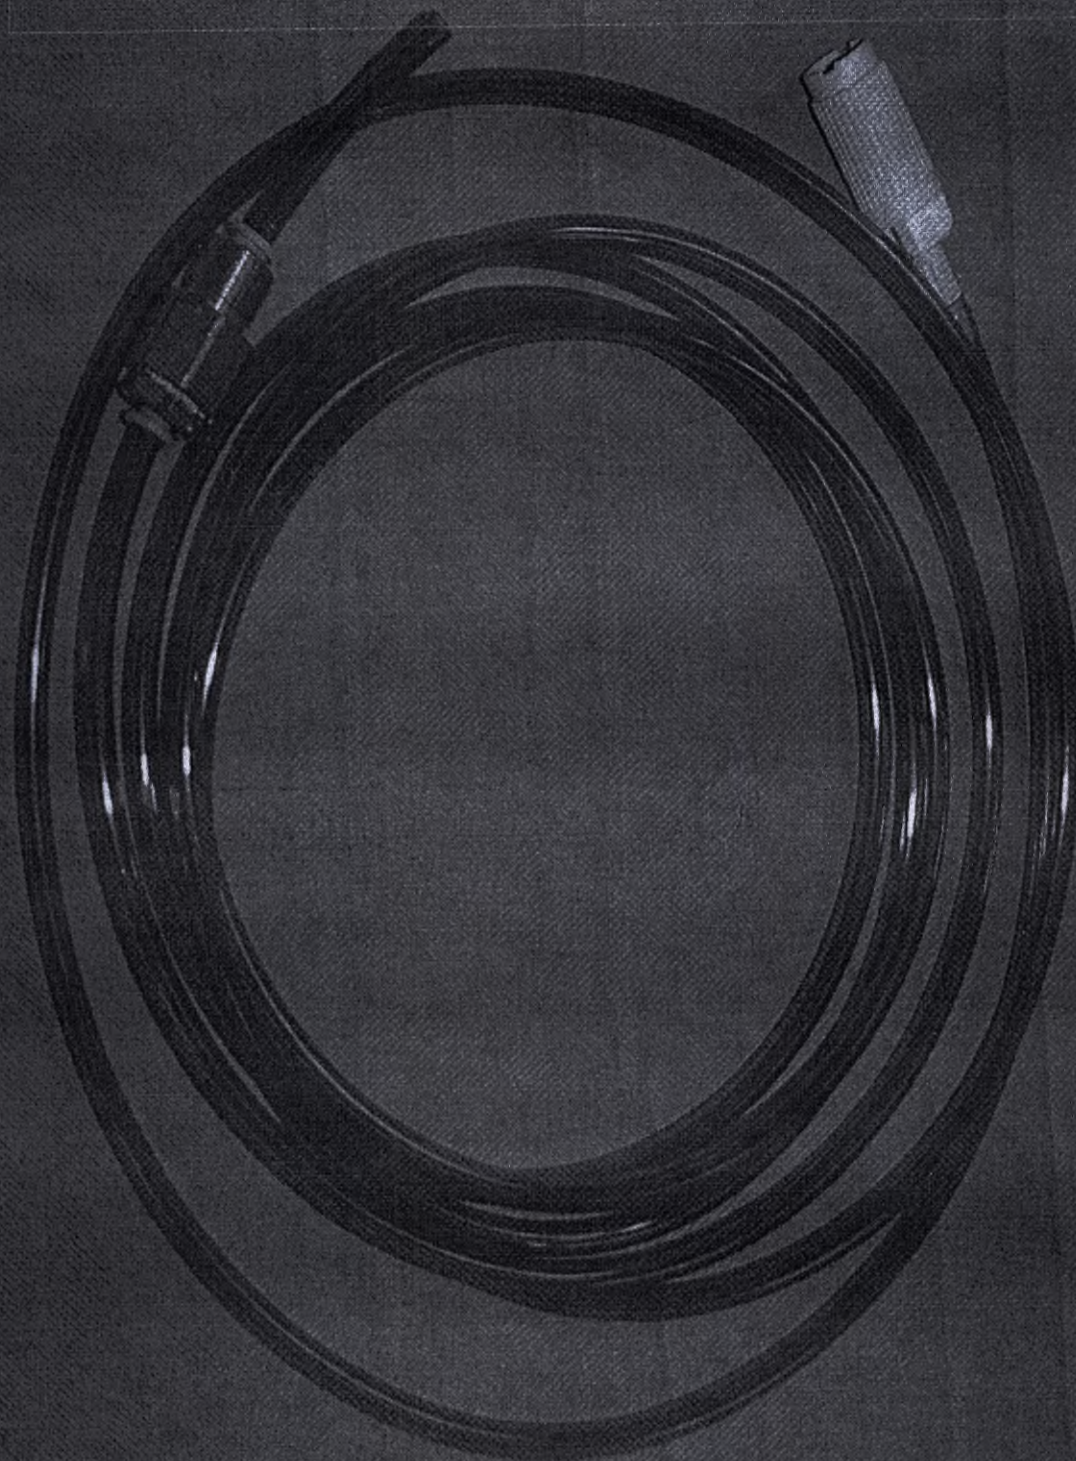


20. Синяя толстая трубка 3м со штуцером (1 шт.).

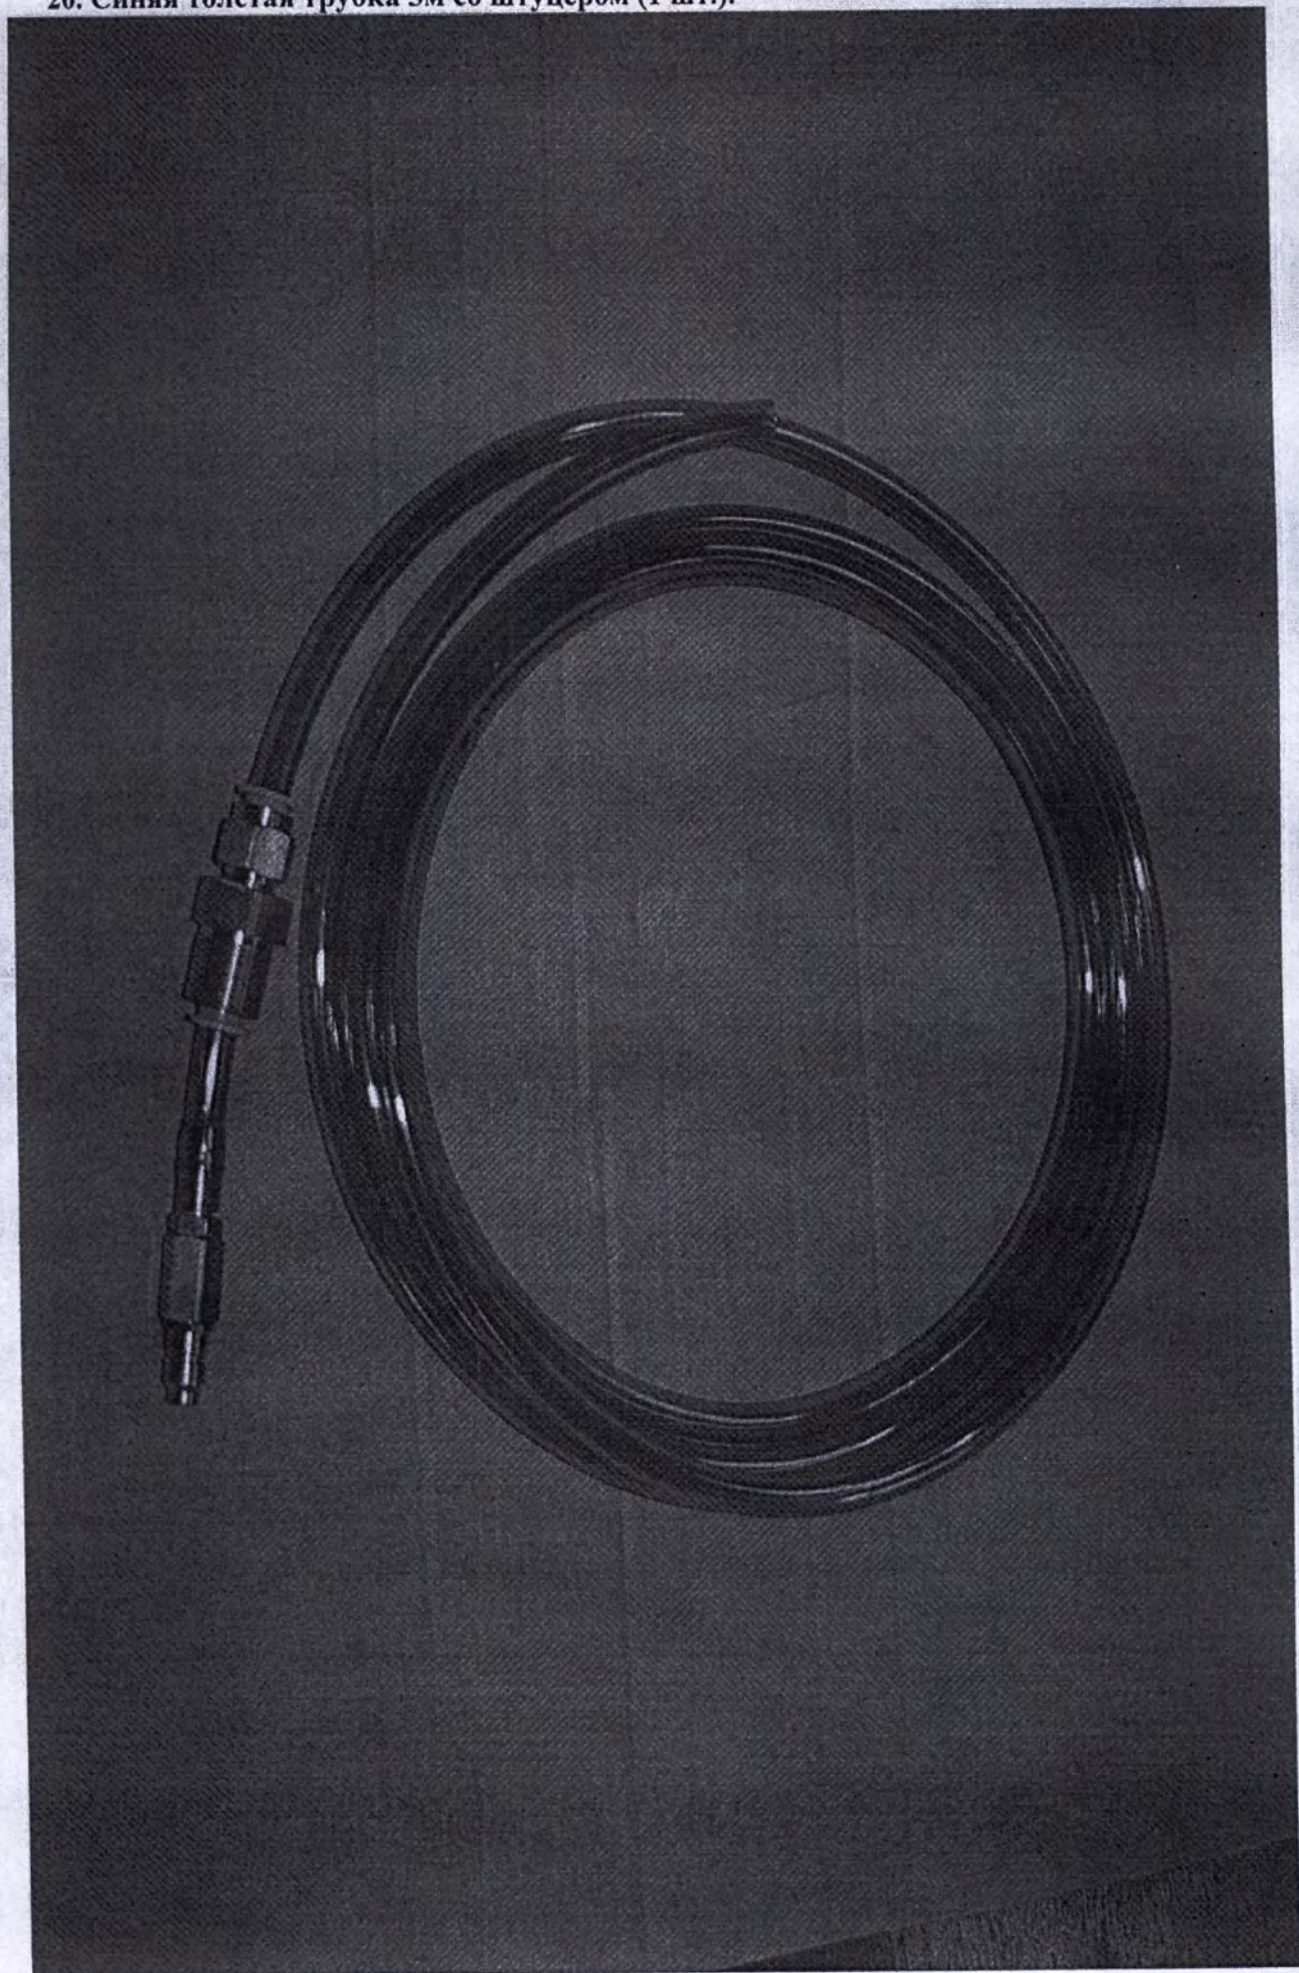

21. Соединительная трубка для отходов красного цвета со штуцером 3 м (1 шт.).

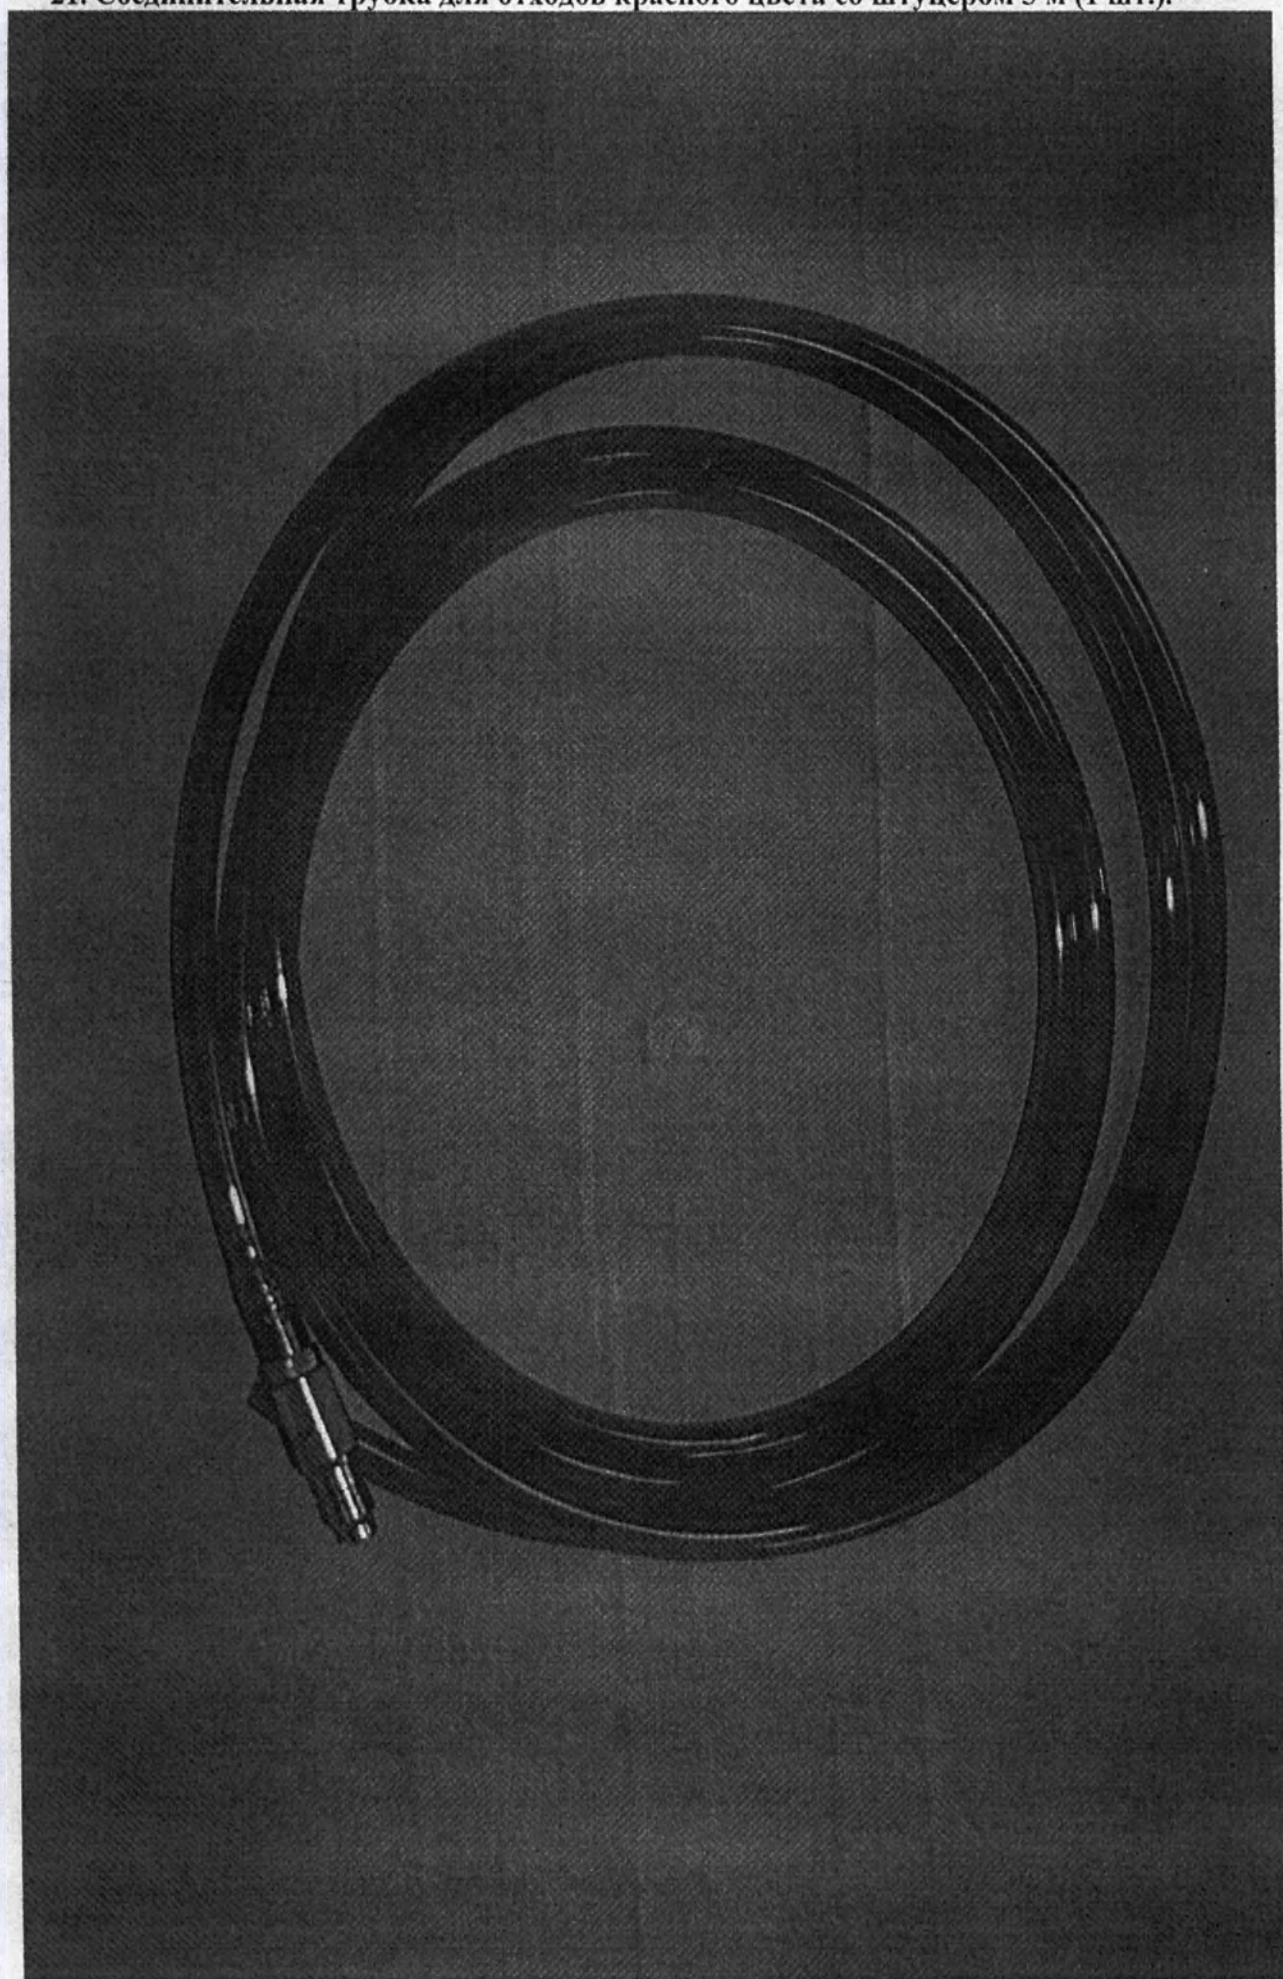

22. Натриевый (Na⁺) электрод – 1 шт.

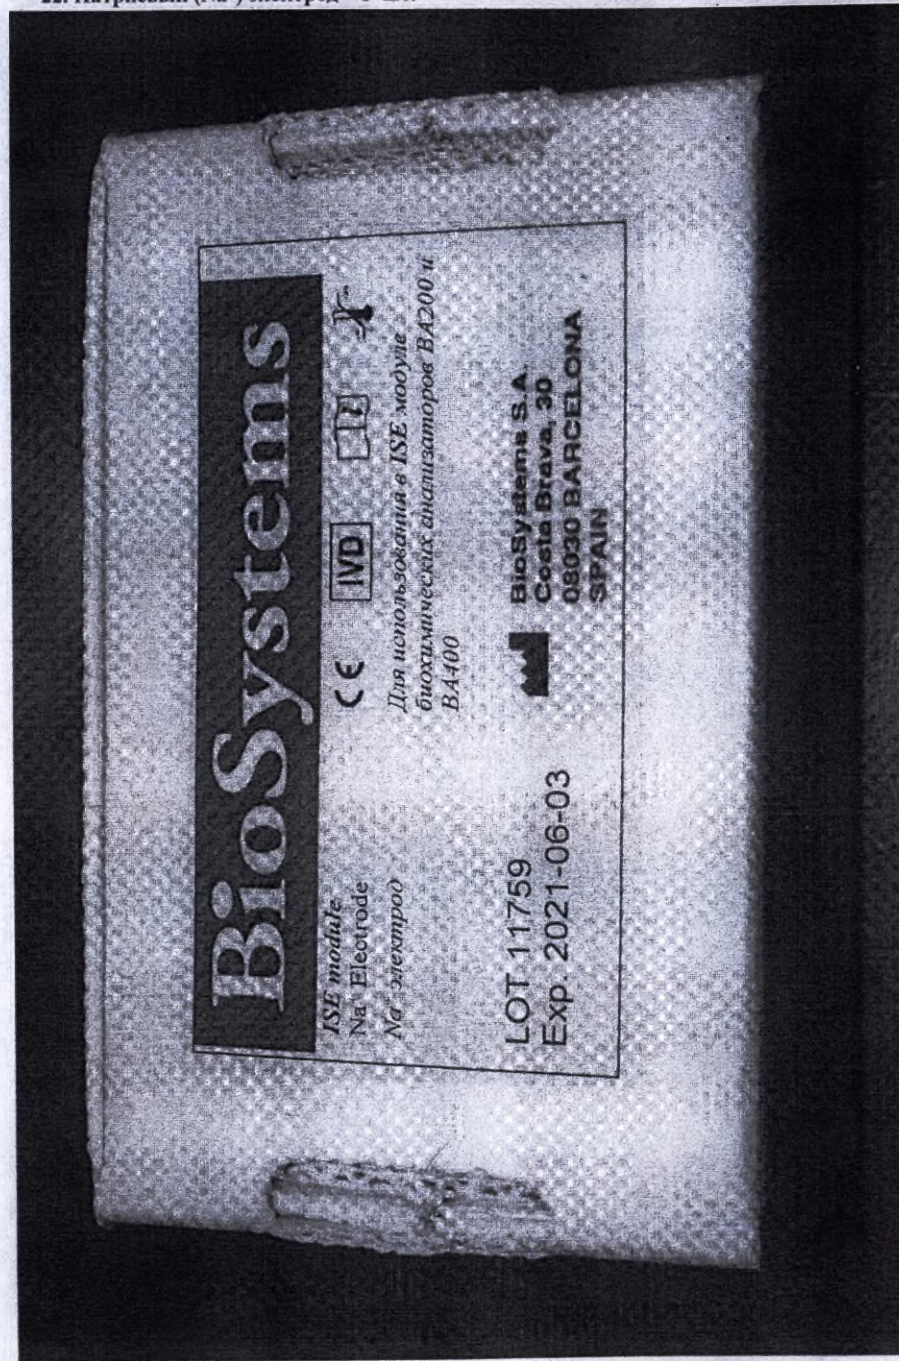

BioSystems


ISE module
K⁺ Electrode
K⁺ электрод


CE IVD


Для использования в ISE модуле
биохимических анализаторов BA200 и
BA400


LOT 16087
Exp. 2019-01-19

BioSystems S.A.
Costa Brava, 30
08030 BARCELONA
SPAIN

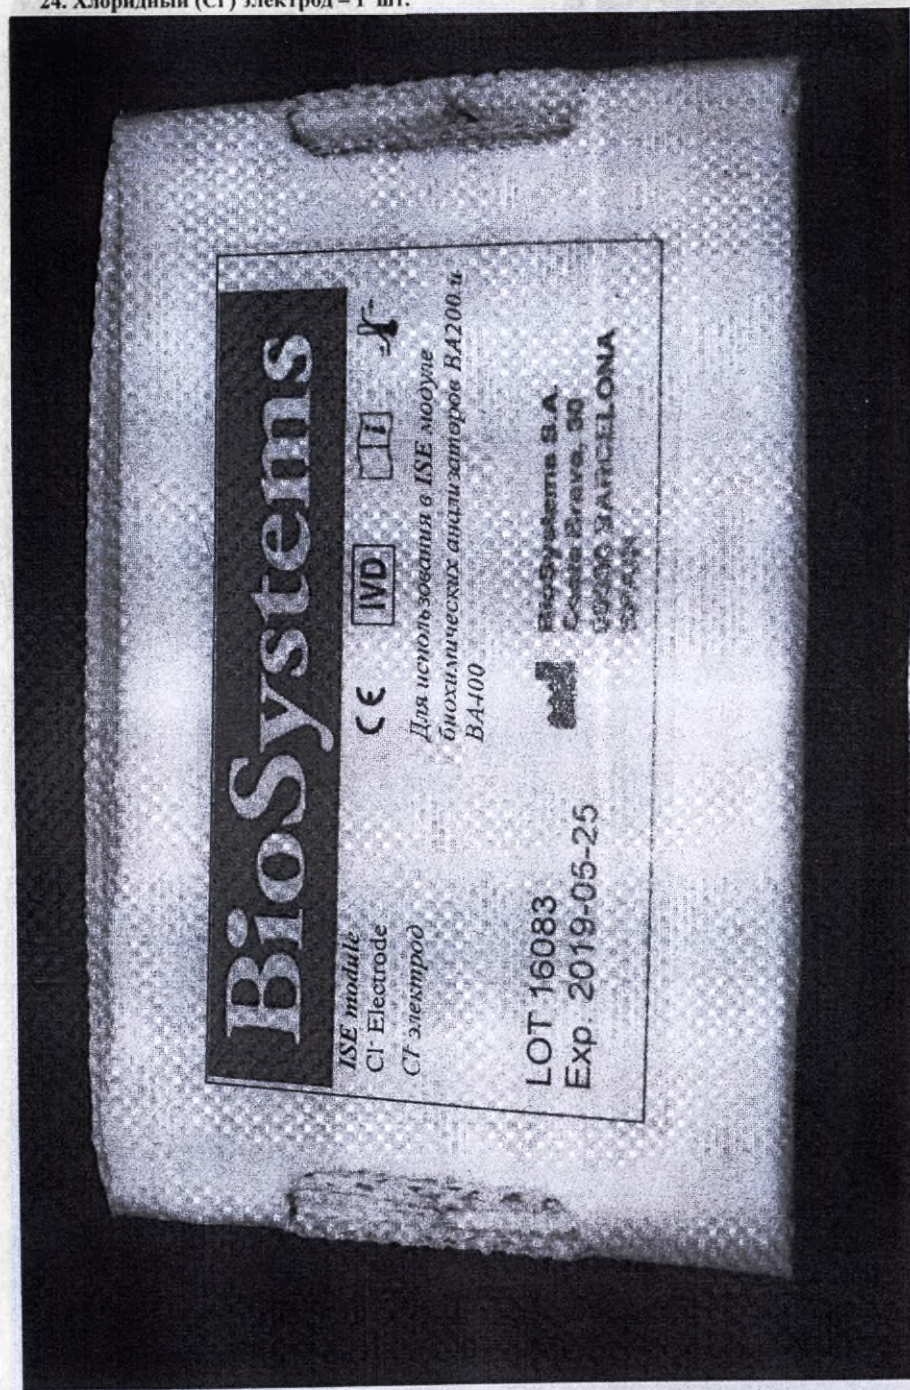


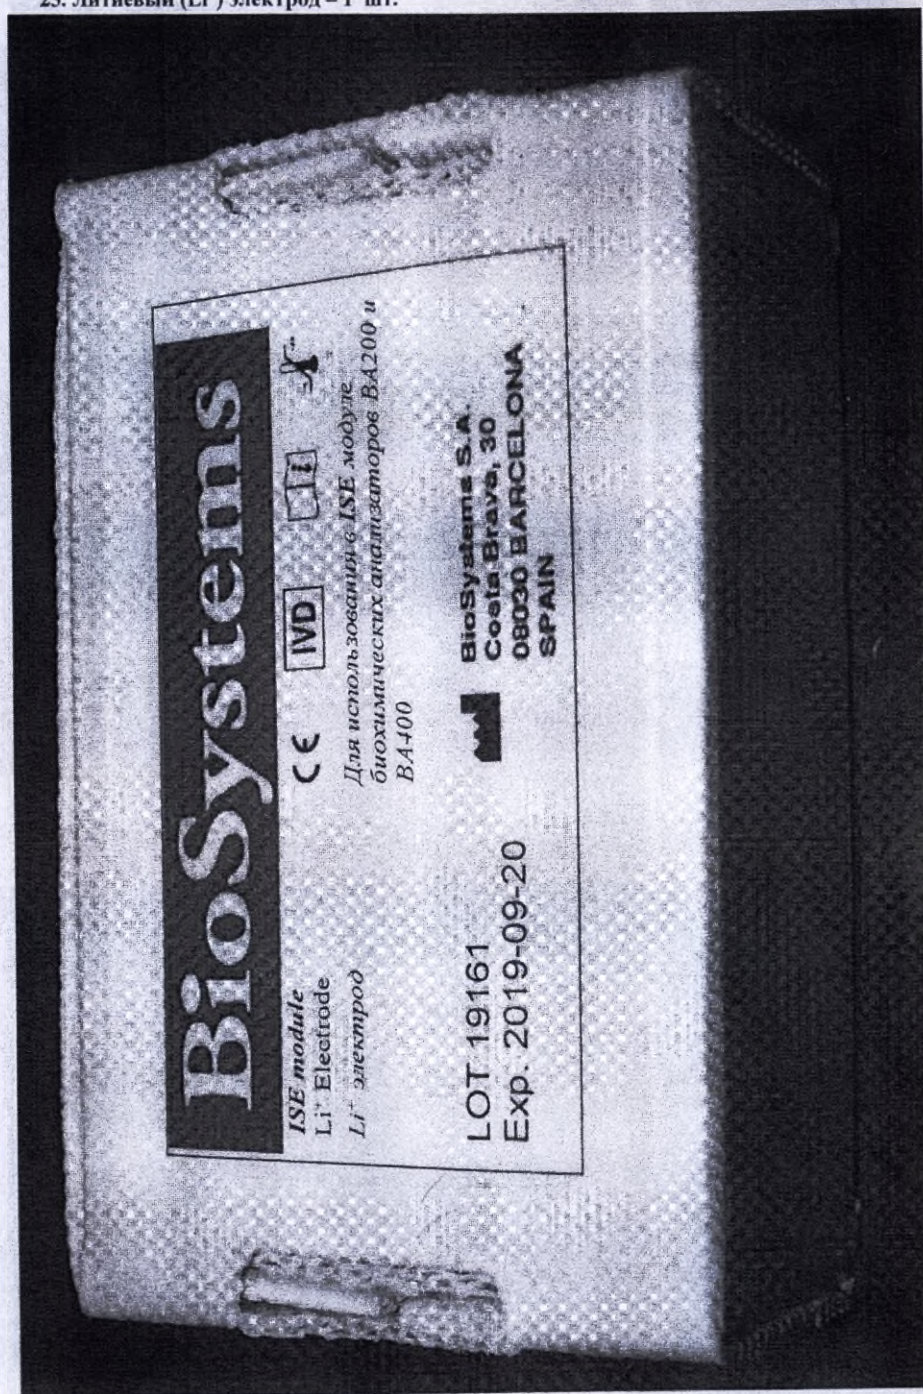

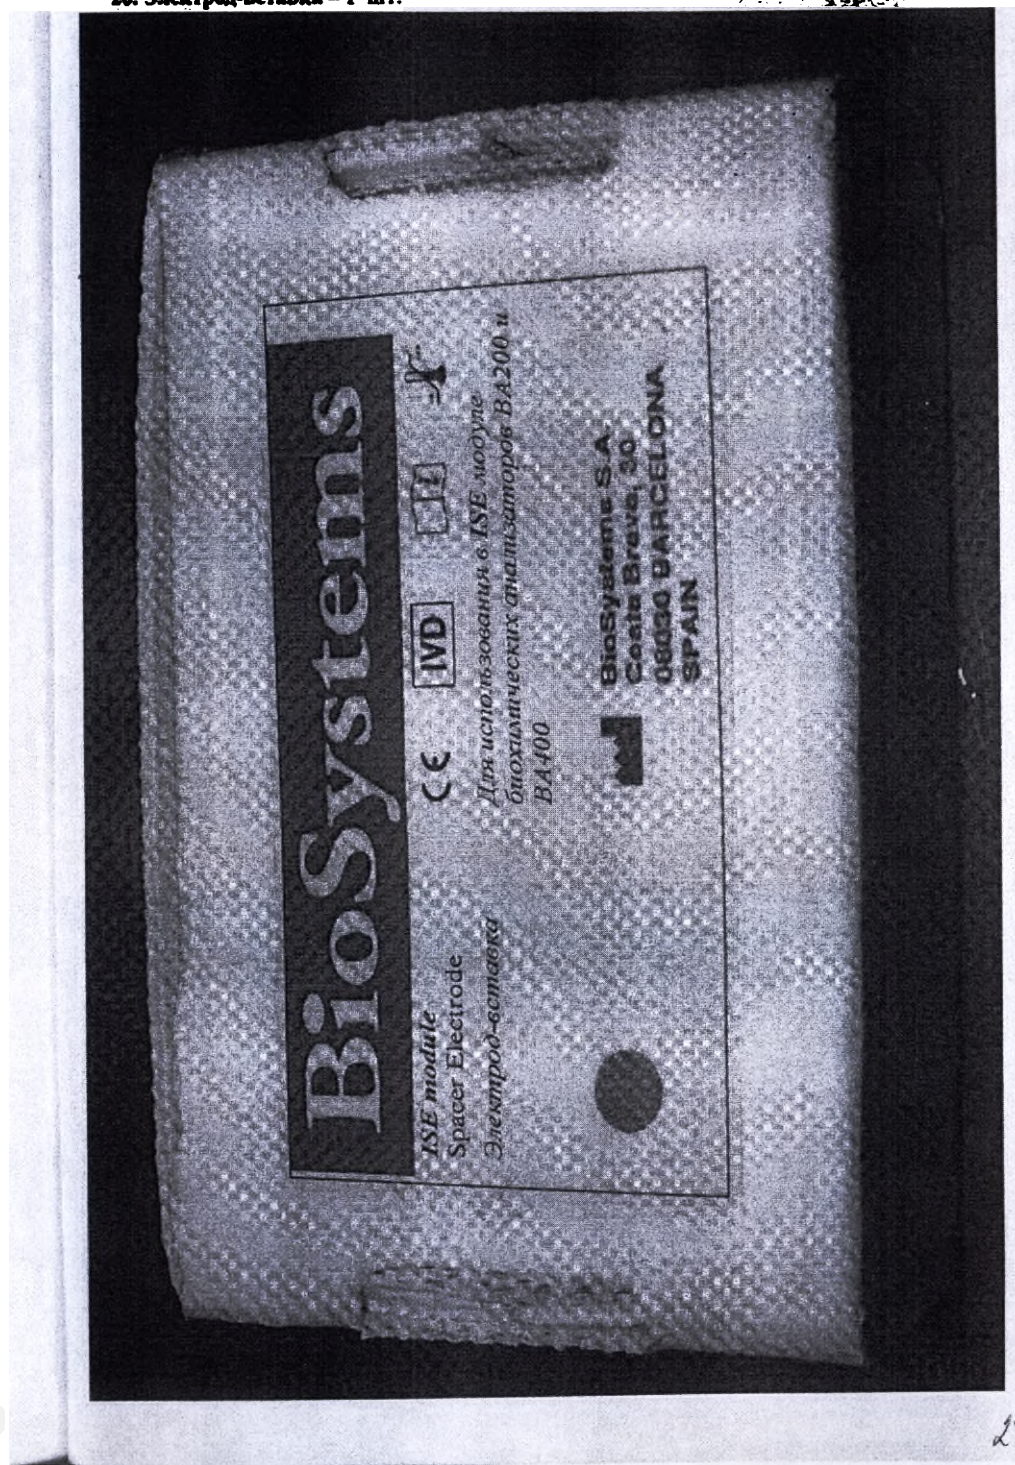


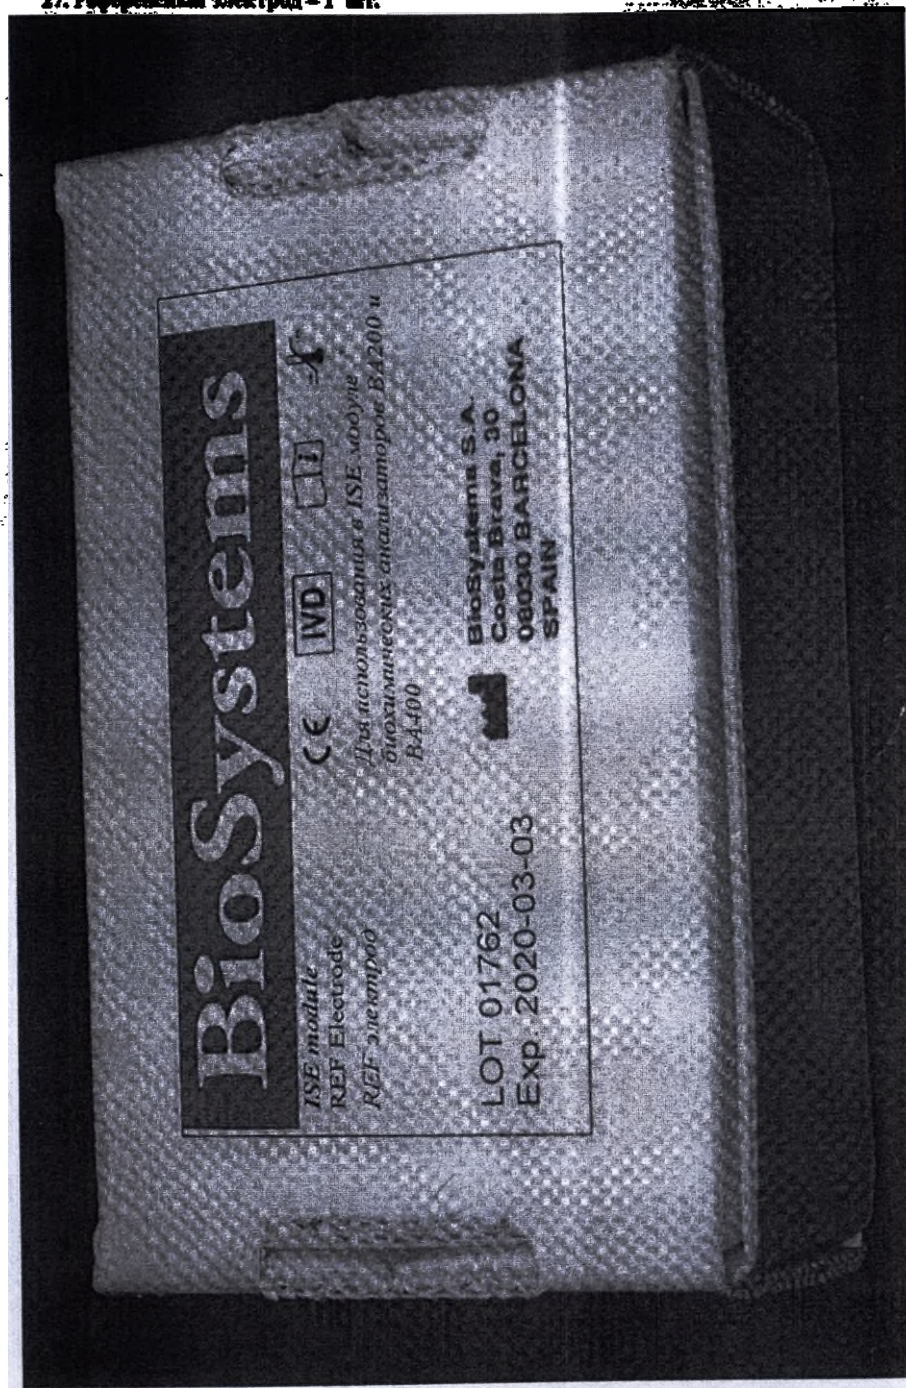


28. Реагентный пакет $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-/\text{Li}^+$ - 1 шт.

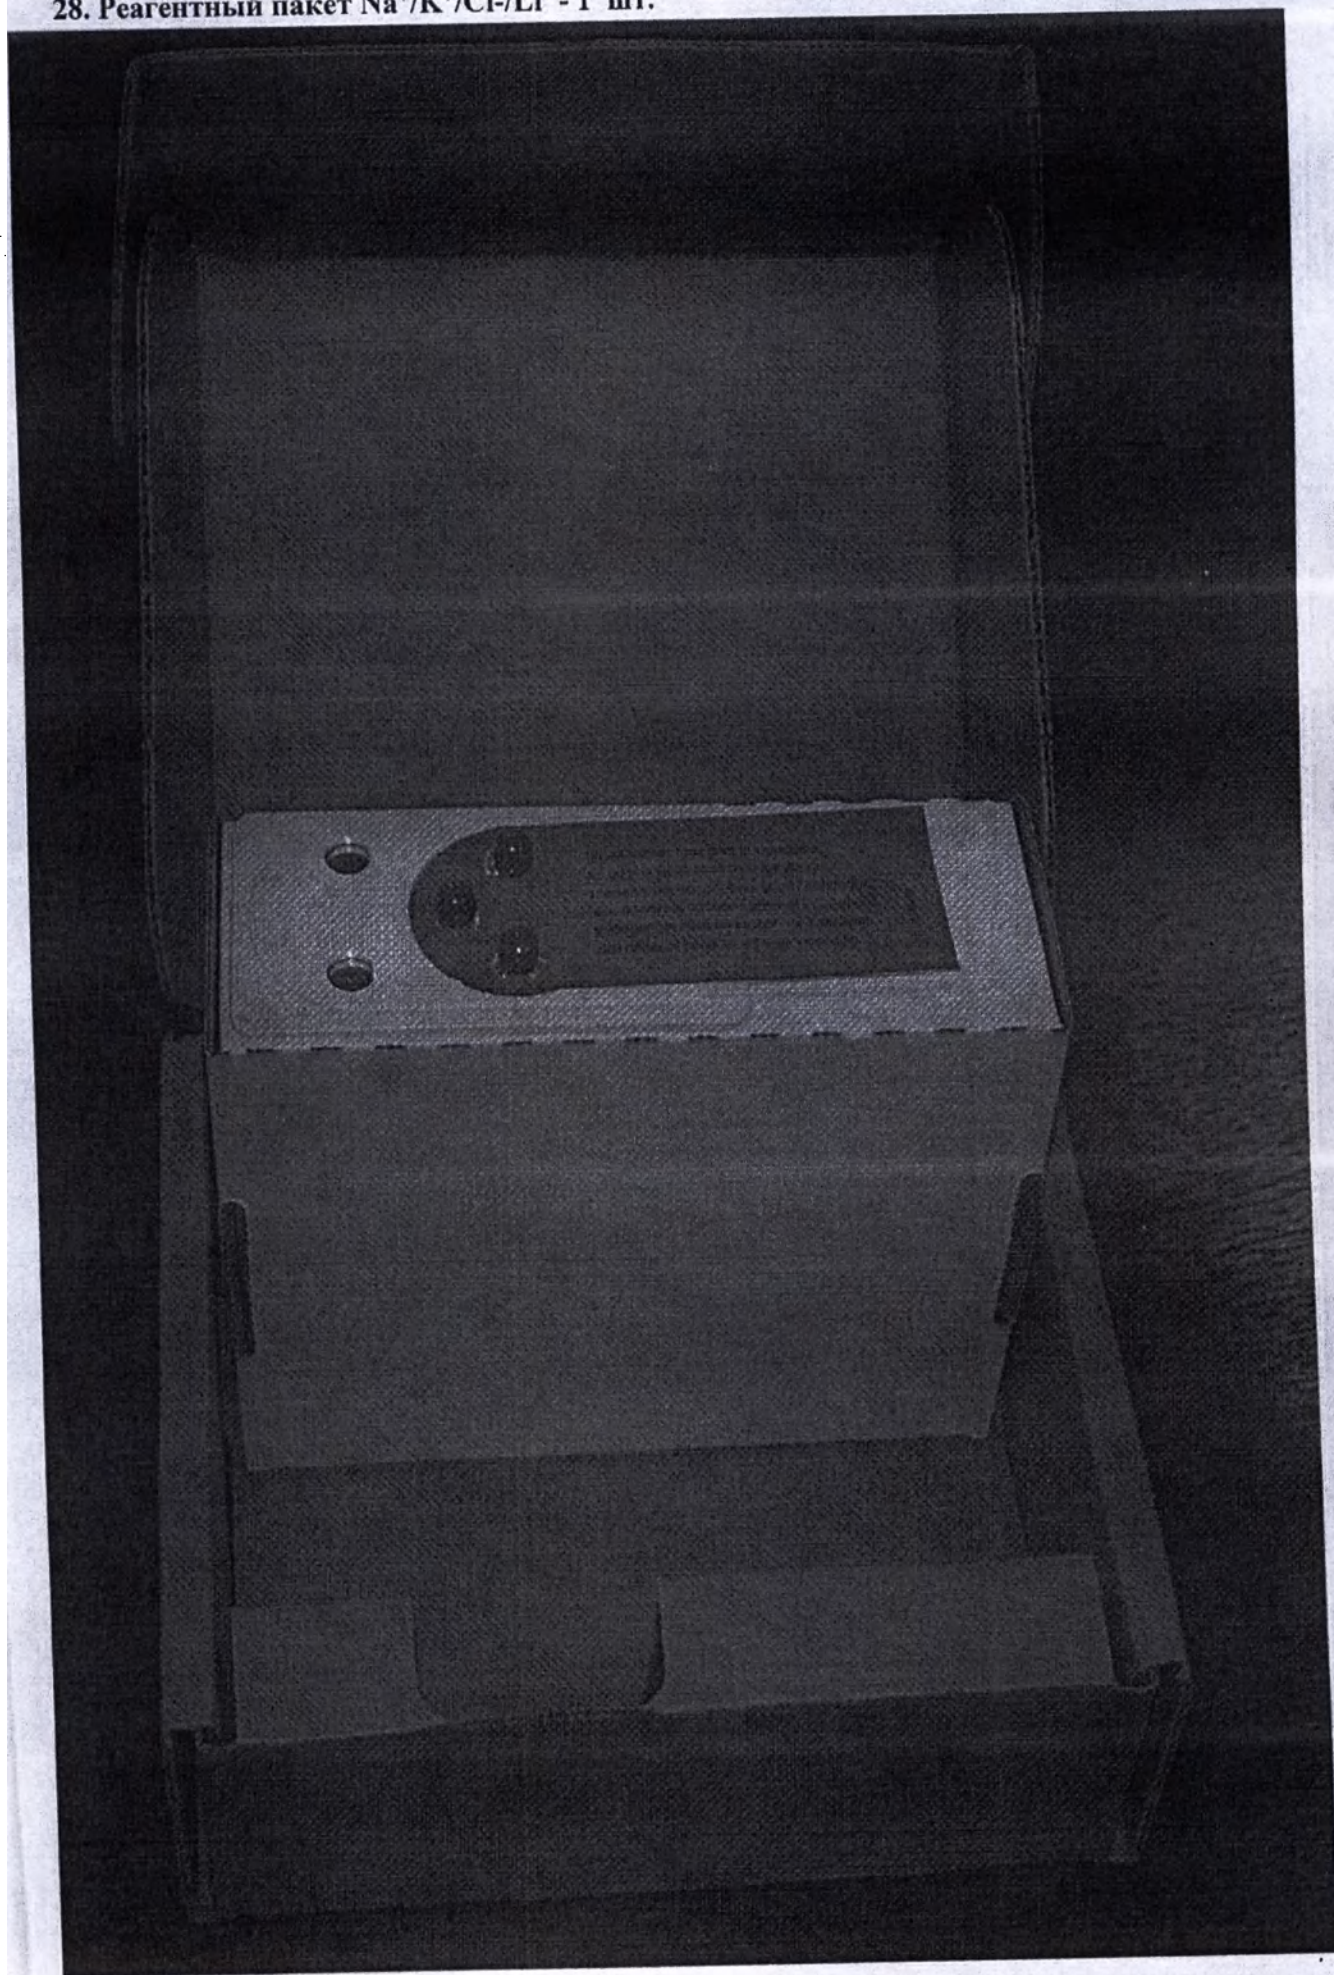


29. Разбавитель для мочи 125 мл – 1 шт.

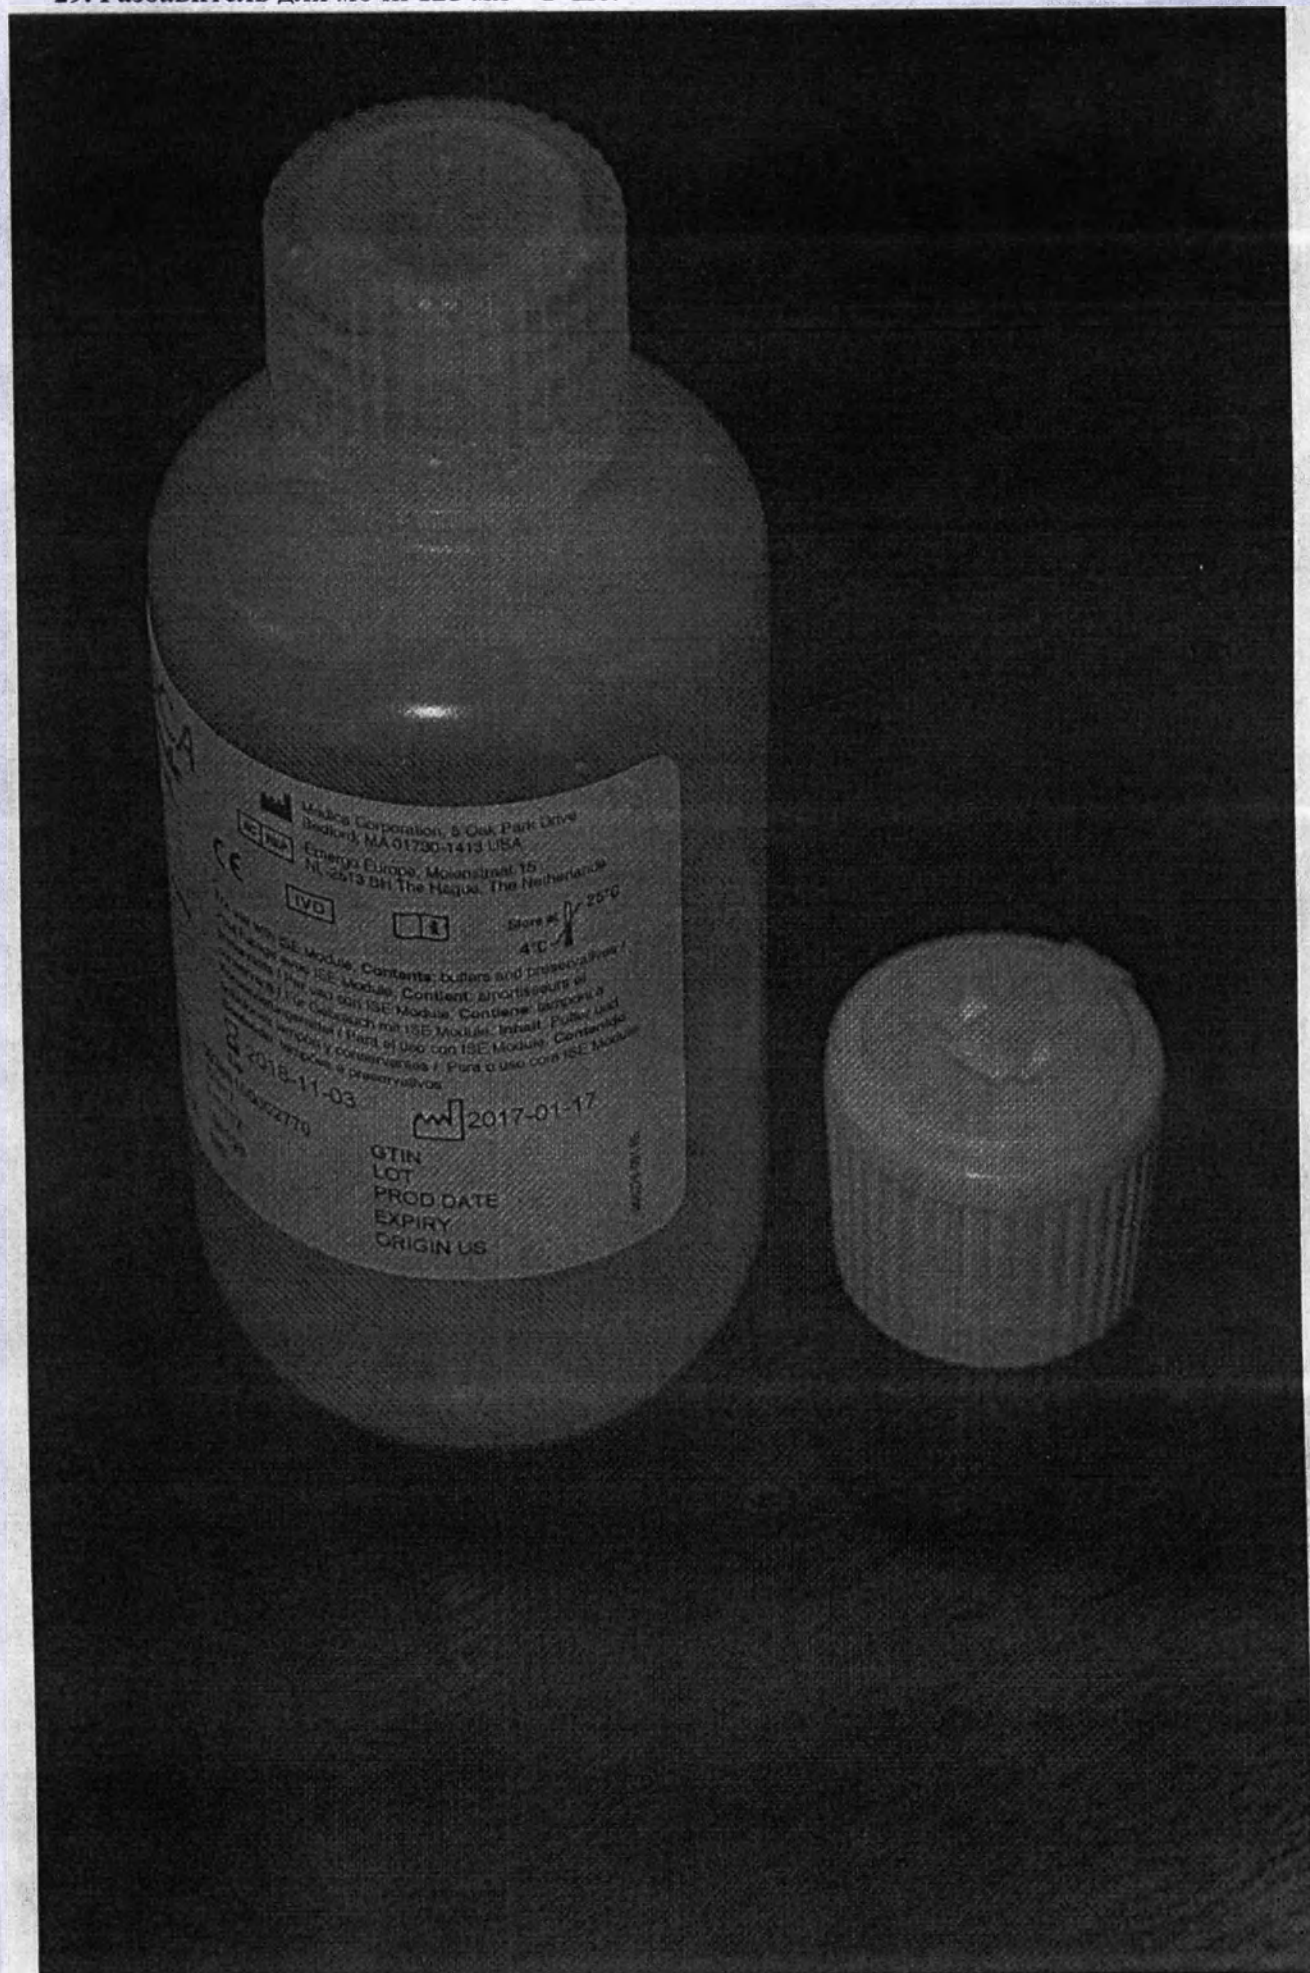

30. Моющий набор: 1 флакон, 90 мл моющий/очищающий раствор; 6 флаконов, 0.3 г
вещи.

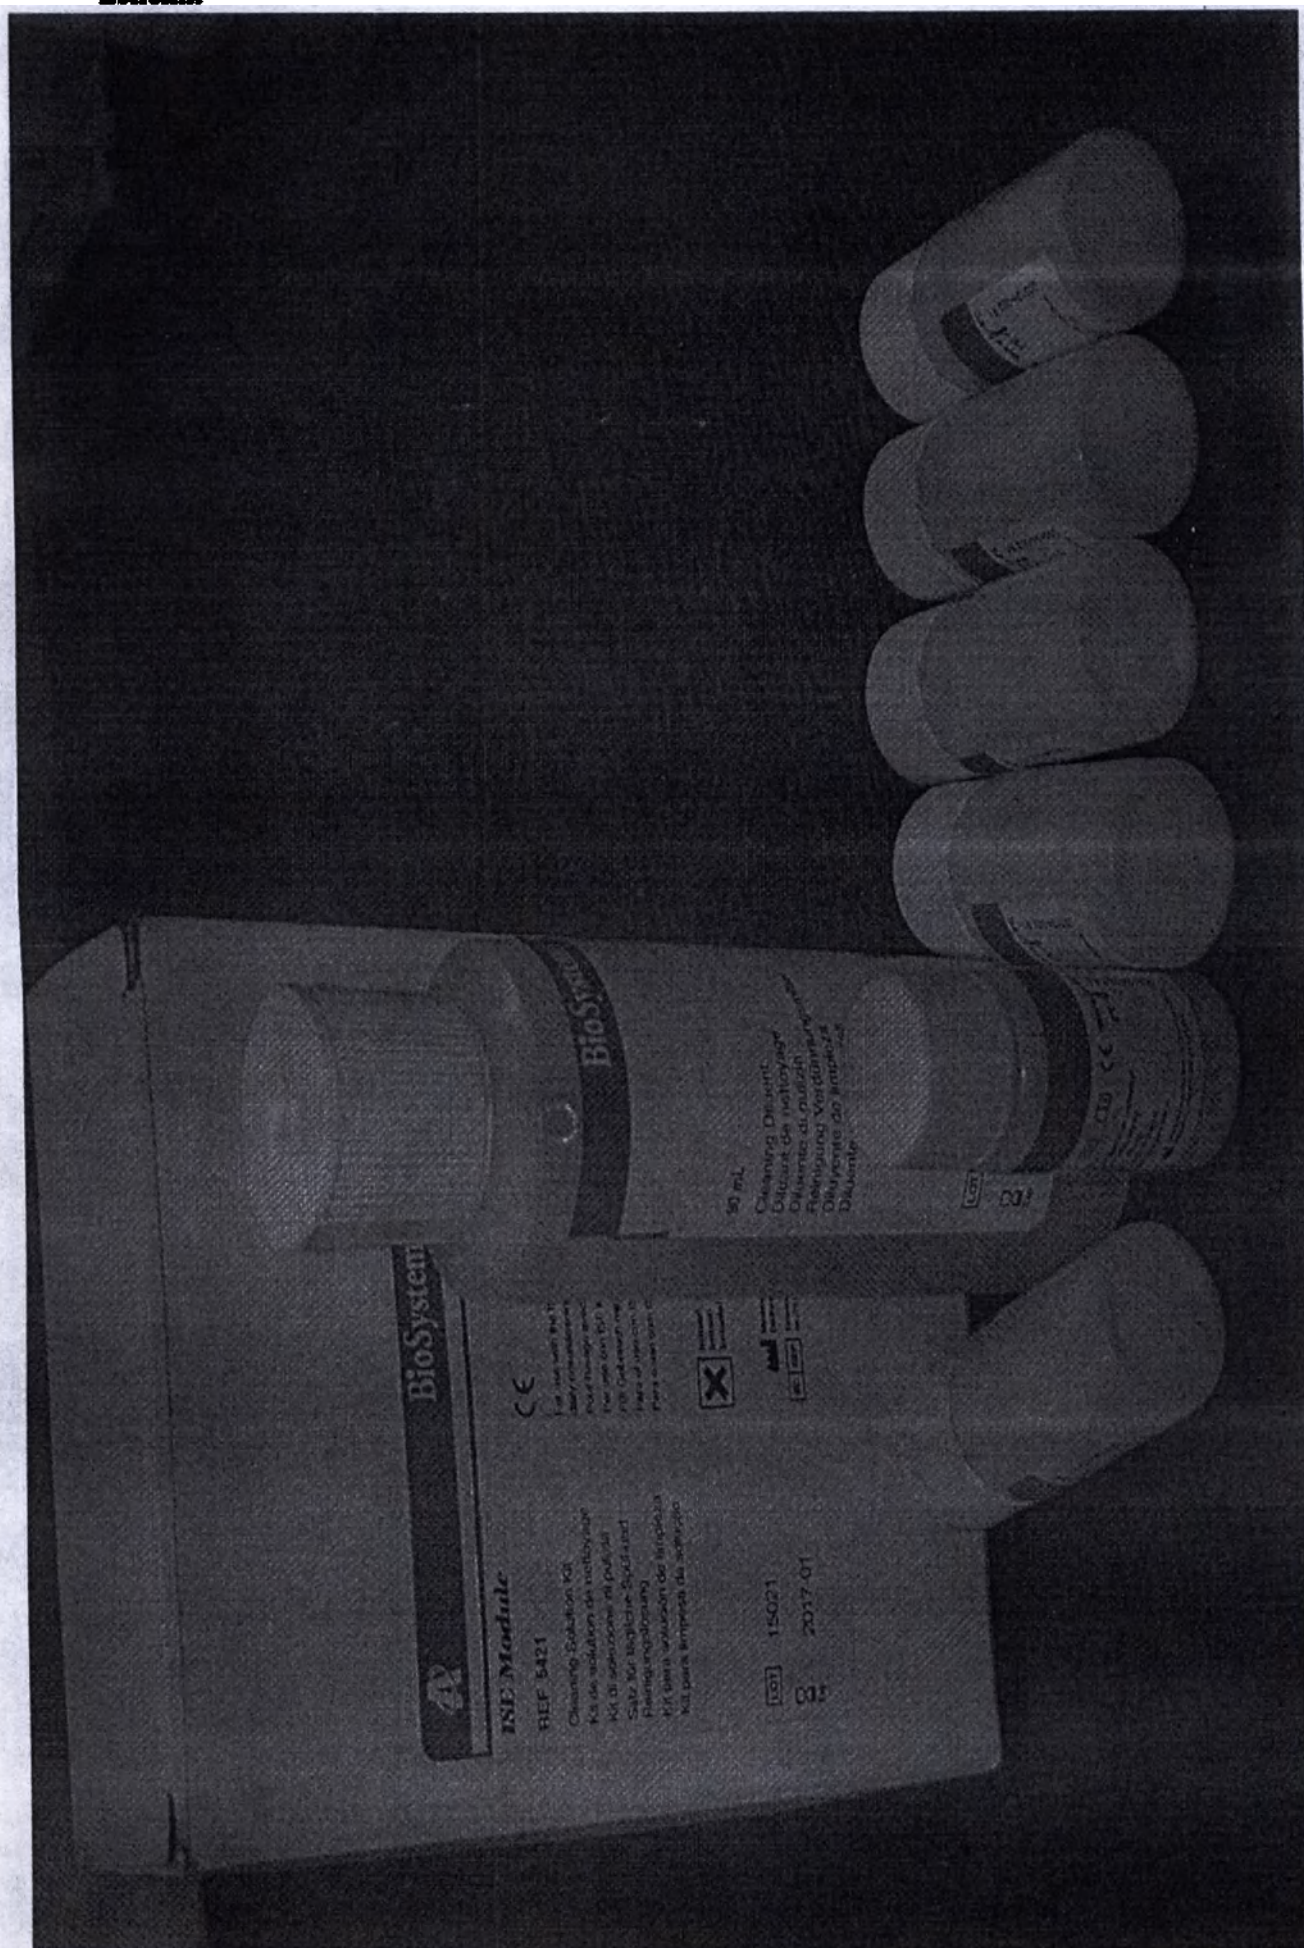

31. Сервисный набор для нон-селективного (ISE) модуля: Ватная палочка; Шприц 10 мл; Желтая игла; Розовая игла; Синяя игла; Основной очиститель; Синяя трубка; Прямоугольная бутылка.

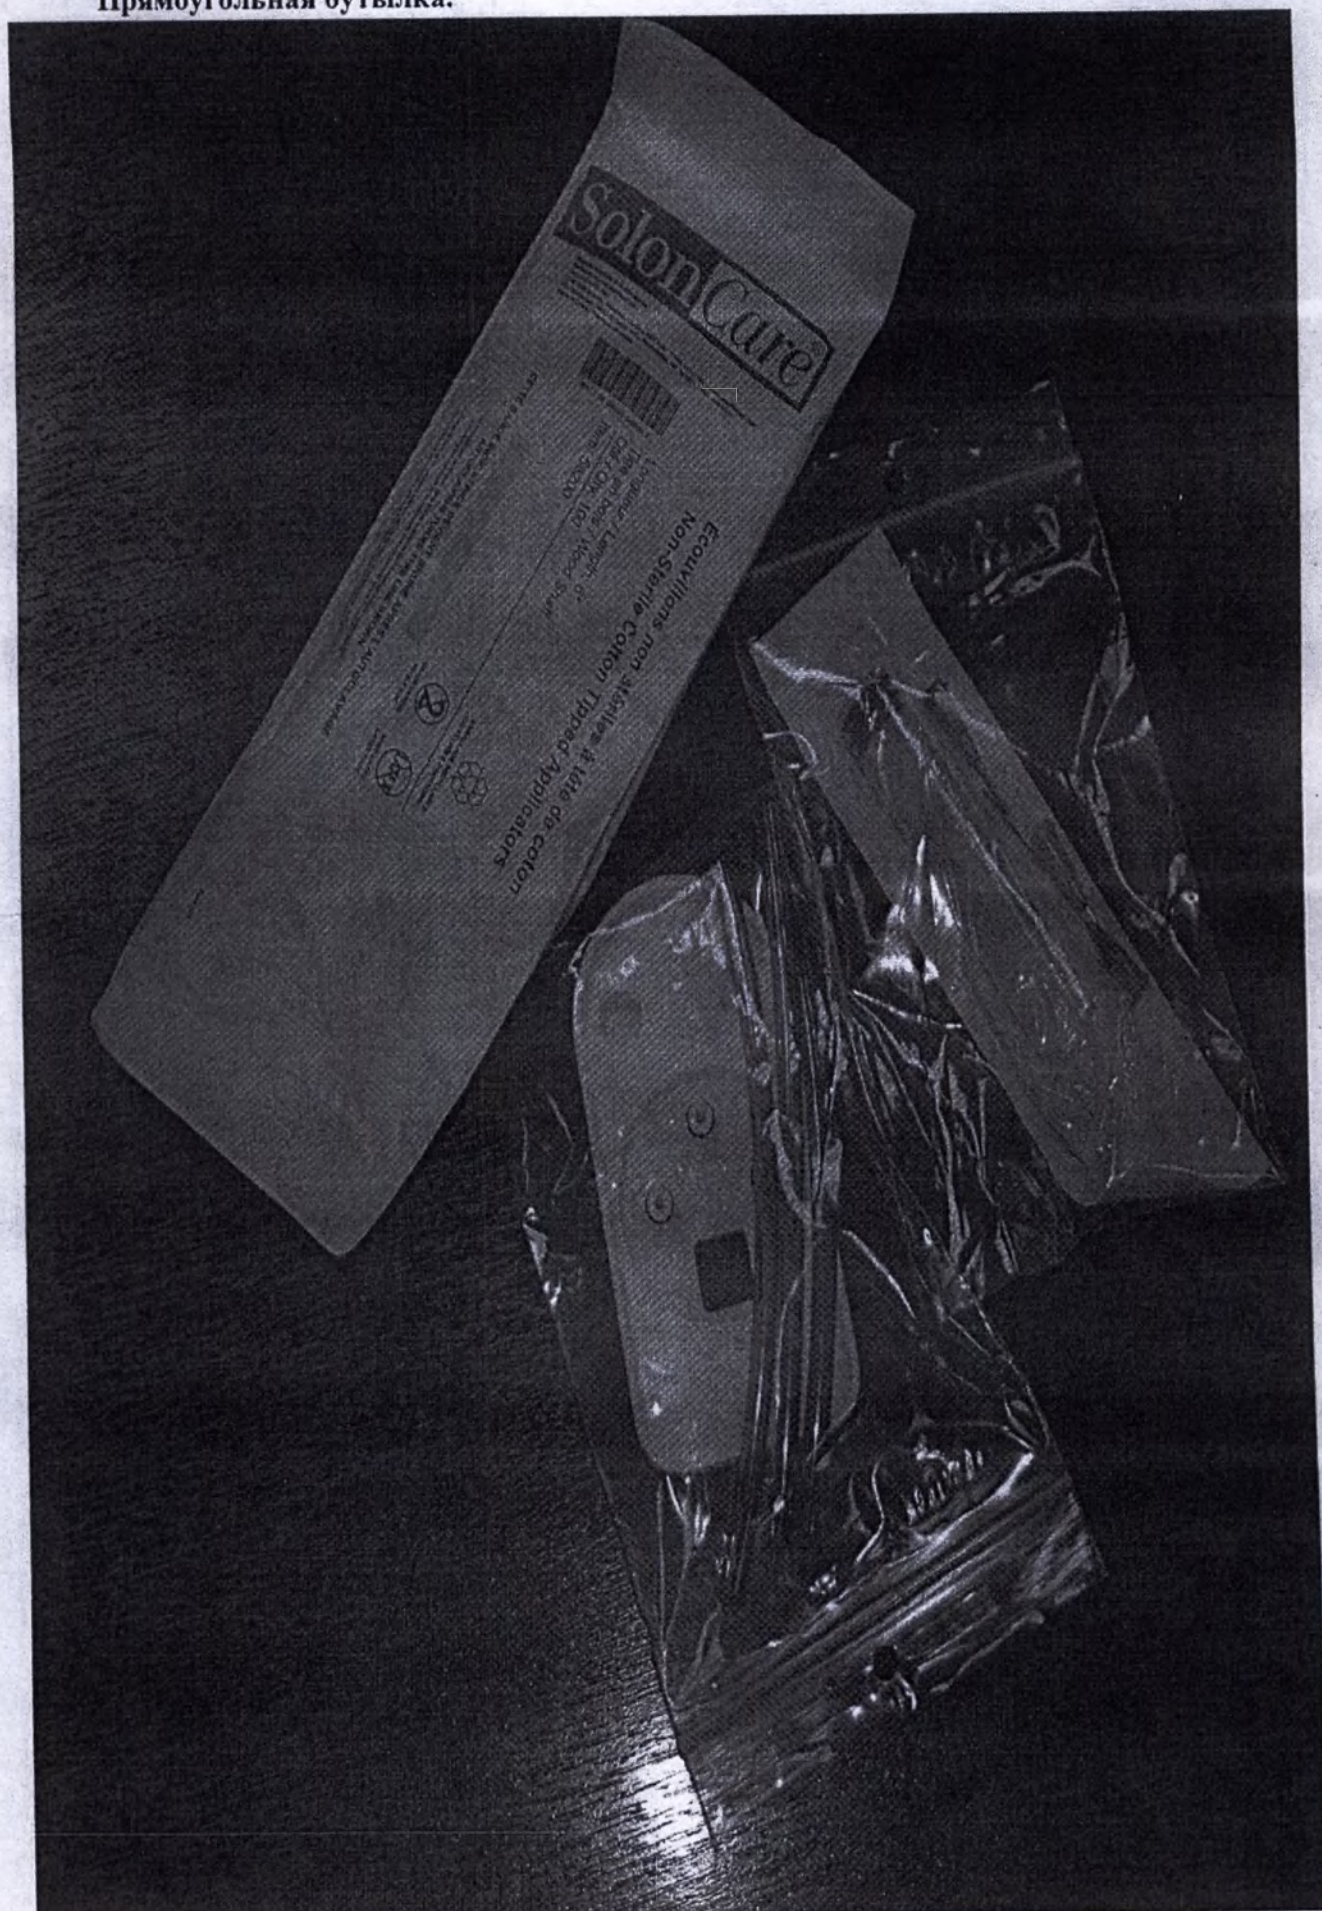

I, Laura López, Regulatory Affairs Manager at BioSystems S.A., hereby certify, that attached documents are true and accurate copies of User Manual BA200 and translation of this document into Russian language i in accordance with the documents.

Also, I hereby certify that the attached documents are for purposes of product registration in Russia and in the countries of Eurasian Economic Union.


Я, Лаура Лопез, Менеджер по Вопросам Регулирования компании BioSystems S.A., настоящим удостоверяю, что прилагаемые документы в нижеприведенном объеме страниц, являются достоверными и точными копиями Руководства Пользователя BA200 и переводом данных документов на русский язык.

Также удостоверяю, что прилагаемые документы используются с целью регистрации продукции в Российской Федерации и странах Евразийского Экономического Союза.

№	Title/Наименование	Number of pages in document/Количество страниц в документе
1.	BA200 User manual (English)/Руководство пользователя BA200 (Английский язык)	219
2.	BA200 User manual (Russian)/Руководство пользователя BA200 (Русский язык)	227


Laura López
Regulatory Affairs Manager
BIOSYSTEMS S.A.




Лаура Лопез
Менеджер по Вопросам Регулирования
BIOSYSTEMS S.A.



BIOSYSTEMS, S.A.
Costa Brava, 30,
08030 BARCELONA
Tel. +34 933 11 00 00

Regulatory Affairs Department
BIOSYSTEMS S.A.
llopez@biosystems.es
Barcelona, July 12th, 2020



• Certified Management System
• EN ISO 9001
• EN ISO 13485

T E S T I M O N I O.- ANTONIO ROSSELLÓ MESTRE, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Barcelona, -----

DOY FE: Que el presente testimonio es fiel reproducción, por fotocopia, del documento original, que me exhibe. Y para que conste libro el presente.-----
Barcelona, a dos de septiembre de dos mil veinte.---

Figura en el libro indicador con el N° 878/2020 de la Sección Segunda.-----



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Antonio Roselló Mestre', written over a horizontal line.