

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

2024 г.



Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*:

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы
в сыворотке и плазме крови оптимизированным
энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023



Комплектация №1	стр. 2
Комплектация №2	стр. 3
Комплектация №3	стр. 4
Комплектация №4	стр. 5
Комплектация №5	стр. 6
Комплектация №6	стр. 7
Комплектация №7	стр. 8
Комплектация №8	стр. 9
Комплектация №9	стр. 10
Комплектация №10	стр. 11
Макет транспортной (групповой) упаковки	стр 12

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Макет этикеток



Комплектация № 1

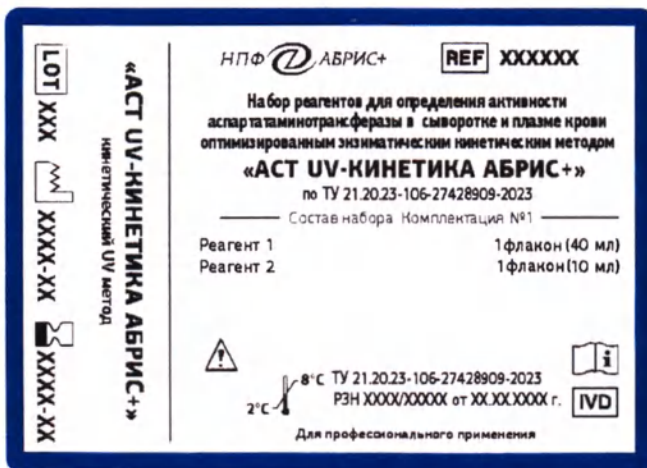

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Макет этикеток



Комплектация № 2

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX	«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» кинетический UV метод	НПФ АБРИС+	REF XXXXXX
		Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023	
		Состав набора. Комплектация №2	
		Реагент 1 Реагент 2	1 флакон (80 мл) 1 флакон (20 мл)

8°C
 2°C
 ТУ 21.20.23-106-27428909-2023
 РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Для профессионального применения

НПФ АБРИС+	REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»	
Реагент 1 80 мл	
8°C 2°C	LOT XXX XXXX-XX

НПФ АБРИС+	REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»	
Реагент 2 20 мл	
8°C 2°C	LOT XXX XXXX-XX

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Макет этикеток



Комплектация № 3

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023 Состав набора. Комплектация №3
	Реагент 1 5 флаконов (по 16 мл) Реагент 2 5 флаконов (по 4 мл)
	8°C ТУ 21.20.23-106-27428909-2023 РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г. Для профессионального применения

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 1 16 мл LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 1 16 мл LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 1 16 мл LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 1 16 мл LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 1 16 мл LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 2 4 мл LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 2 4 мл LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 2 4 мл LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 2 4 мл LOT XXX XXXX-XX IVD







НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 2 4 мл LOT XXX XXXX-XX IVD

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Макет этикеток



Комплектация № 4

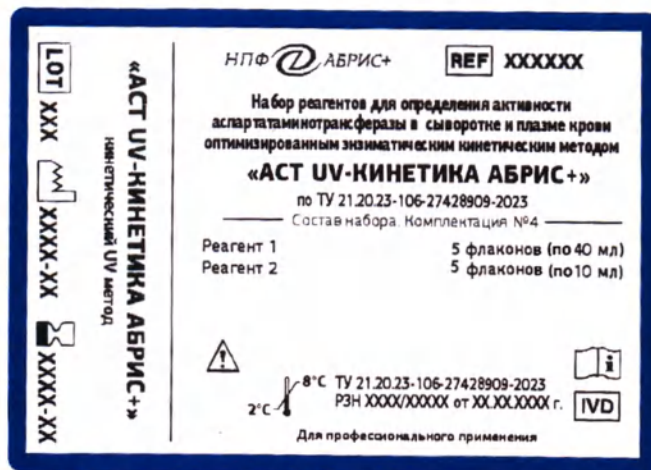

Комплектация № 5

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023
Состав набора Комплектация №5

Реагент 1 2 флакона (по 200 мл)
Реагент 2 2 флакона (по 50 мл)

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»
Кинетический UV метод

8°C ТУ 21.20.23-106-27428909-2023
2°C РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Для профессионального применения

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 1
200 мл

LOT XXX XXXX-XX

8°C 2°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 1
200 мл

LOT XXX XXXX-XX

8°C 2°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 2
50 мл

LOT XXX XXXX-XX

8°C 2°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 2
50 мл

LOT XXX XXXX-XX

8°C 2°C

IVD

Комплектация № 6

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023
Состав набора Комплектация №6

Реагент 1 3 флакона (по 200 мл)
Реагент 2 3 флакона (по 50 мл)

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»
кинетический UV метод

ТУ 21.20.23-106-27428909-2023
РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Для профессионального применения

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 1
200 мл

LOT XXX XXXX-XX

2°C 8°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 1
200 мл

LOT XXX XXXX-XX

2°C 8°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 1
200 мл

LOT XXX XXXX-XX

2°C 8°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 2
50 мл

LOT XXX XXXX-XX

2°C 8°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 2
50 мл

LOT XXX XXXX-XX

2°C 8°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 2
50 мл

LOT XXX XXXX-XX

2°C 8°C

IVD

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Макет этикеток



Комплектация № 7

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX	«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Кинетический UV метод	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023 Состав набора. Комплектация №7 Реагент 1 6 флаконов (по 16 мл) Реагент 2 2 флакона (по 12 мл)
		2°C / 8°C ТУ 21.20.23-106-27428909-2023 РЗН XXX/XXXX от XX.XX.XXXX Для профессионального применения

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C / 8°C LOT XXX XXXX-XX	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C / 8°C LOT XXX XXXX-XX
НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C / 8°C LOT XXX XXXX-XX	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C / 8°C LOT XXX XXXX-XX
НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C / 8°C LOT XXX XXXX-XX	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C / 8°C LOT XXX XXXX-XX
НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 2 12 мл 2°C / 8°C LOT XXX XXXX-XX	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» Реагент 2 12 мл 2°C / 8°C LOT XXX XXXX-XX

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Макет этикеток



Комплектация № 8

LOT
XXX

XXXX-XX

XXXX-XX

НПФ АБРИС+ **REF** XXXXXX

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме
крови оптимизированным энзиматическим
кинетическим методом

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Состав набора. Комплектация №8

Реагент 1	2 флакона (по 40 мл)
Реагент 2	1 флакон (20 мл)

2°C

8°C
 ТУ 21.20.23-106-27428909-2023
 РЗН XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

Для профессионального применения

АСТ

НПФ АБРИС+ **REF** XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 1
40 мл

LOT XXX

XXXX-XX

2°C

АСТ

НПФ АБРИС+ **REF** XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 1
40 мл

LOT XXX

XXXX-XX

2°C

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» **REF** XXXXXX

Реагент 2 **20 мл**

LOT XXX

XXXX-XX

2°C

АСТ

Комплектация № 9



Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Макет этикеток



Комплектация № 10

LOT XXX

REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

лиофилизат

кинетический UV метод.

XXXX-XX

XXXX-XX

НПФ АБРИС+

REF XXXXXX

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Состав набора. Комплектация №10

Реагент 1	2 флакона (по 50 мл)
Реагент 2 (лиофилизат)	2 флакона

⚠

8°C

2°C

ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

РЭН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Для профессионального применения

IVD

НПФ АБРИС+

REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 1

50 мл

8°C

2°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+

REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 1

50 мл

8°C

2°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+

REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 2 (лиофилизат)

Растворить в 50 мл Реагента 1

8°C

2°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+

REF XXXXXX

«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»

Реагент 2 (лиофилизат)

Растворить в 50 мл Реагента 1

8°C

2°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»


В.М. Марковский

2024 г.



Макет маркировки транспортной (групповой) упаковки
на медицинское изделие для диагностики *in vitro*:

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке
и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

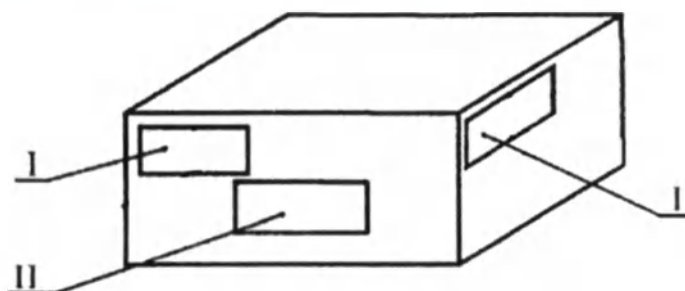

I



II



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Научно-производственная фирма «АБРИС+»

196006, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, литера М, этаж 2.
Тел./факс: (812) 740-1992, 740-1755, 740-1789. Фед. номер: 8-800-333-7324. E-mail: abris@abrisplus.ru

**Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
«АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023**

LOT

xxx

IVD

Количество наборов: XX шт.



xxxx-xx

Масса нетто: XX кг



xxxx-xx

Масса брутто: XX кг



по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Прошито и пронумеровано

12/06/2019 / лист 28

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

03. 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы
в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим
кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Комплектация №1	Общий вид	лист 2
	Вид в упаковке	лист 3
Комплектация №2	Общий вид	лист 4
	Вид в упаковке	лист 5
Комплектация №3	Общий вид	лист 6
	Вид в упаковке	лист 7
Комплектация №4	Общий вид	лист 8
	Вид в упаковке	лист 9
Комплектация №5	Общий вид	лист 10
	Вид в упаковке	лист 11
Комплектация №6	Общий вид	лист 12
	Вид в упаковке	лист 13
Комплектация №7	Общий вид	лист 14
	Вид в упаковке	лист 15
Комплектация №8	Общий вид	лист 16
	Вид в упаковке	лист 17
Комплектация №9	Общий вид	лист 18
	Вид в упаковке	лист 19
Комплектация №10	Общий вид	лист 20
	Вид в упаковке	лист 21

набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023


Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №1



Комплектация №1

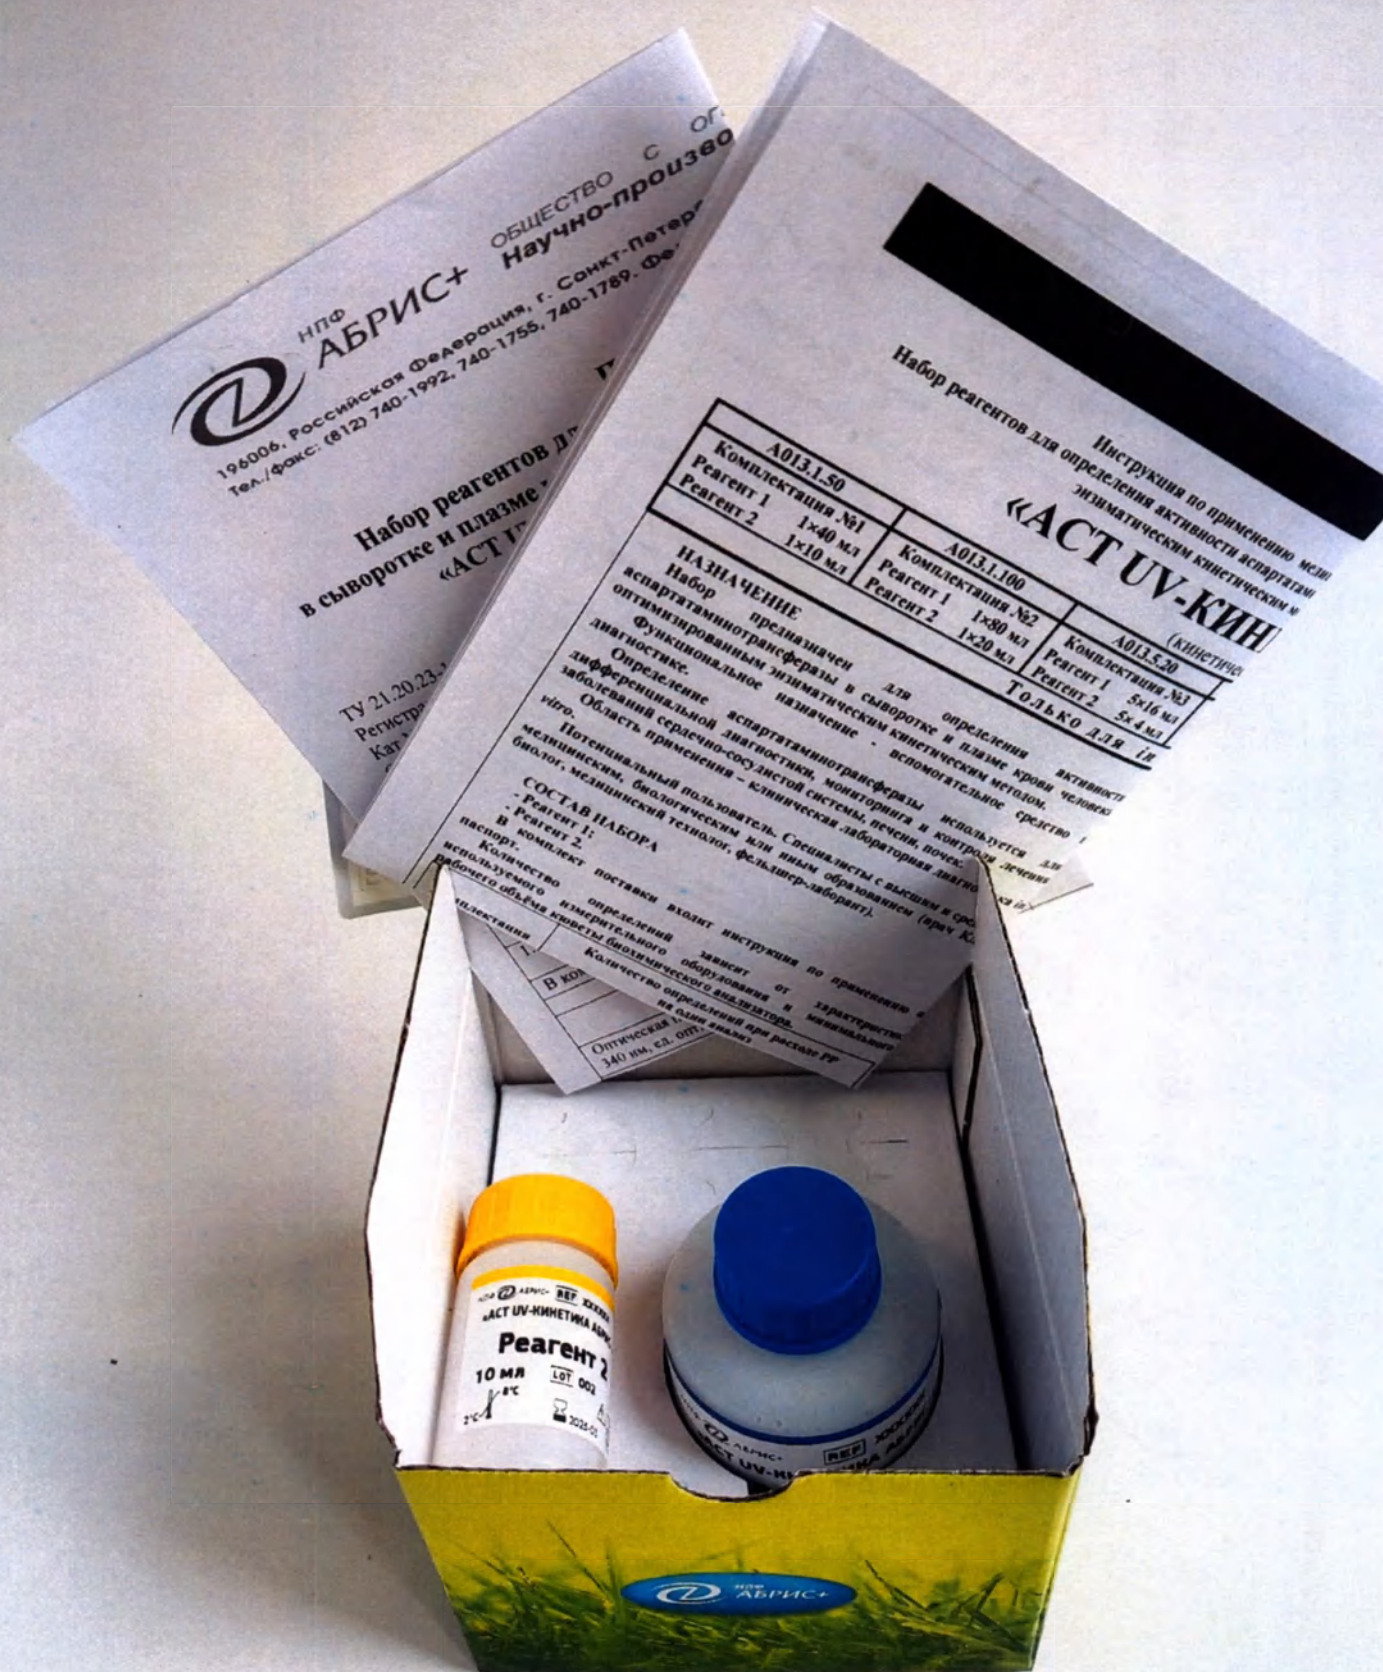


Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №2

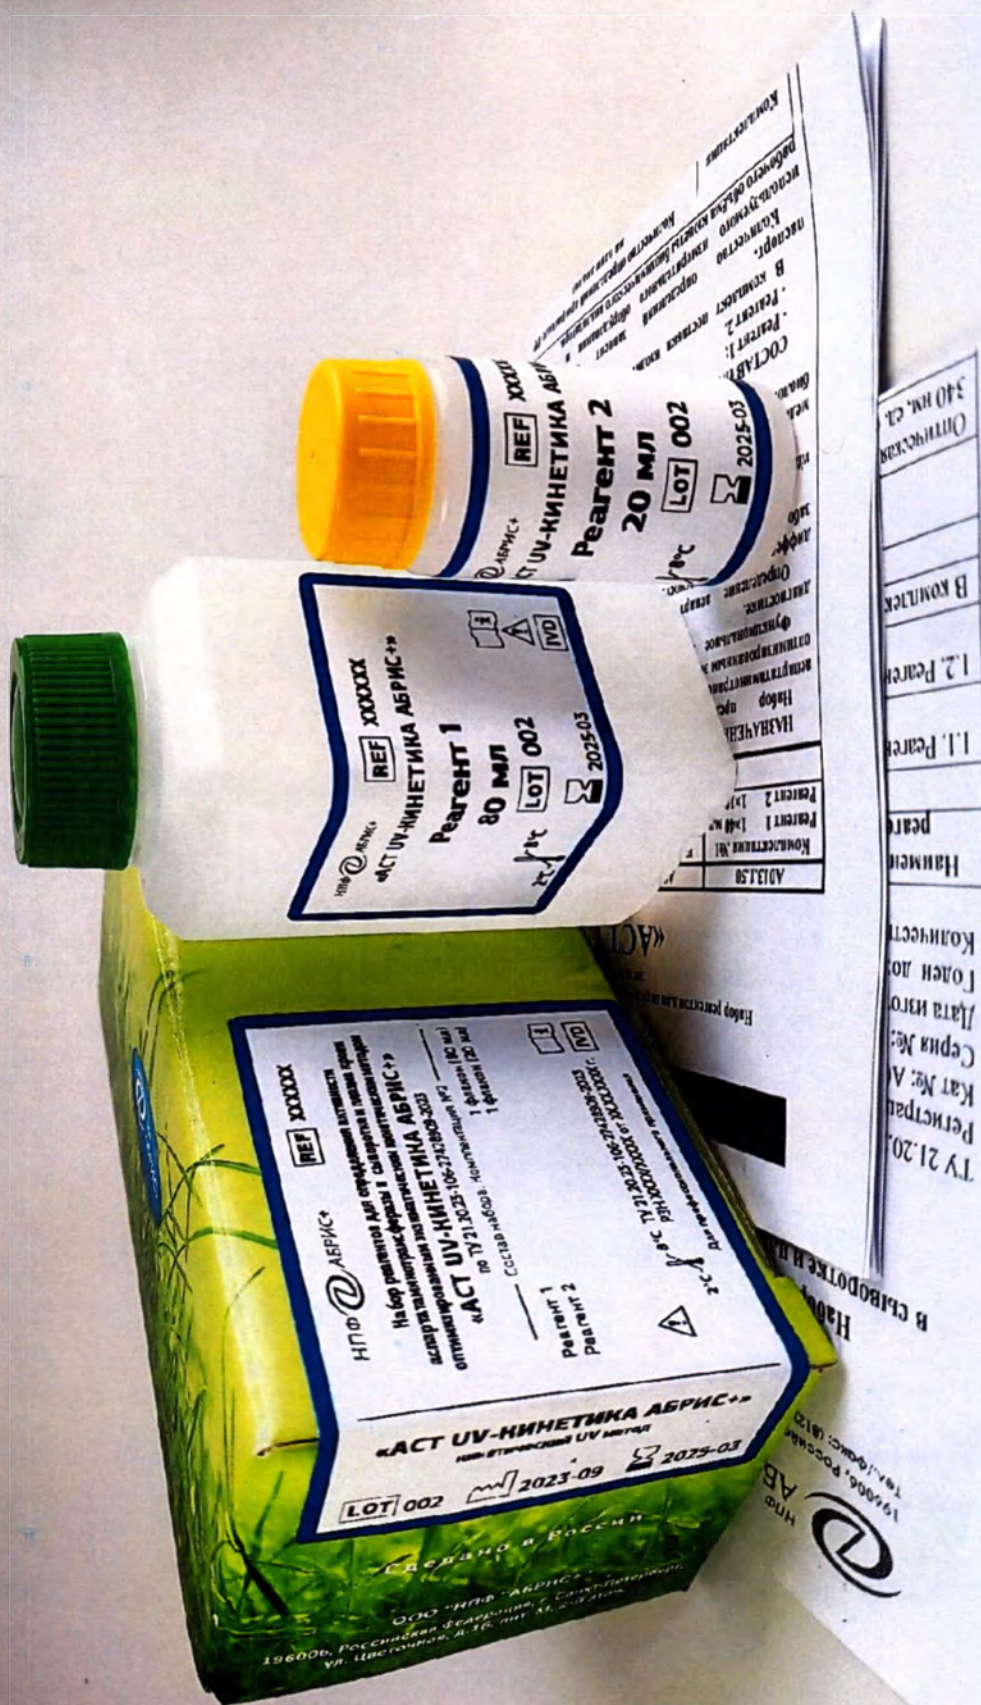


[illegible]

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №3

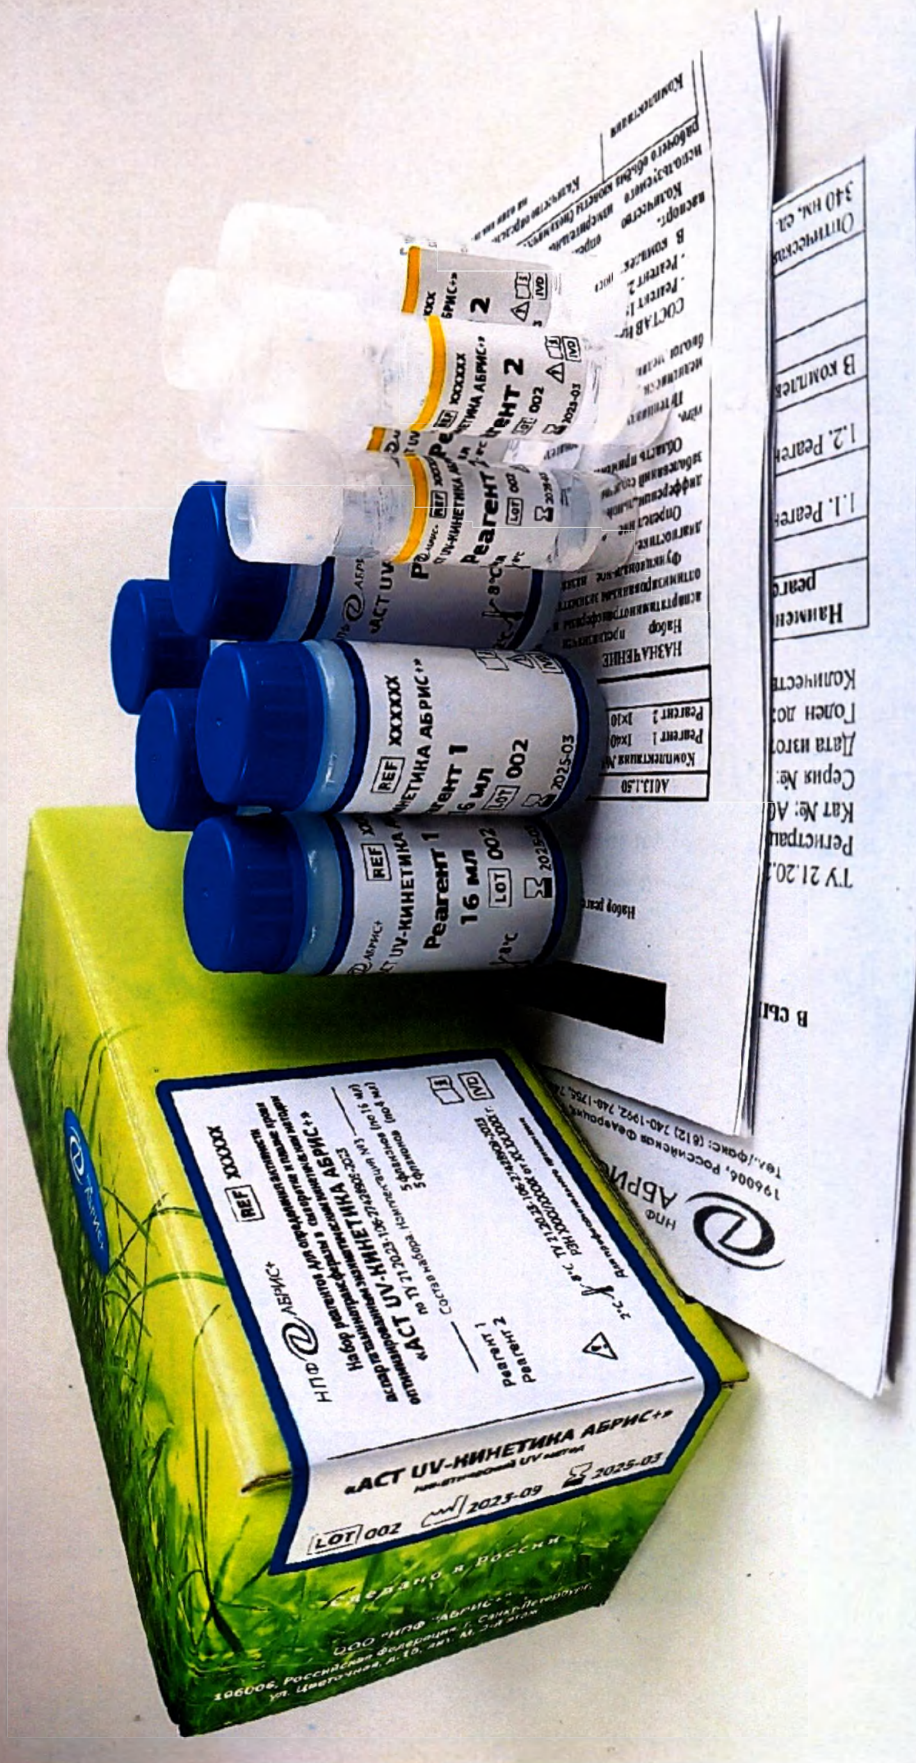

Комплектация №3




Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №4

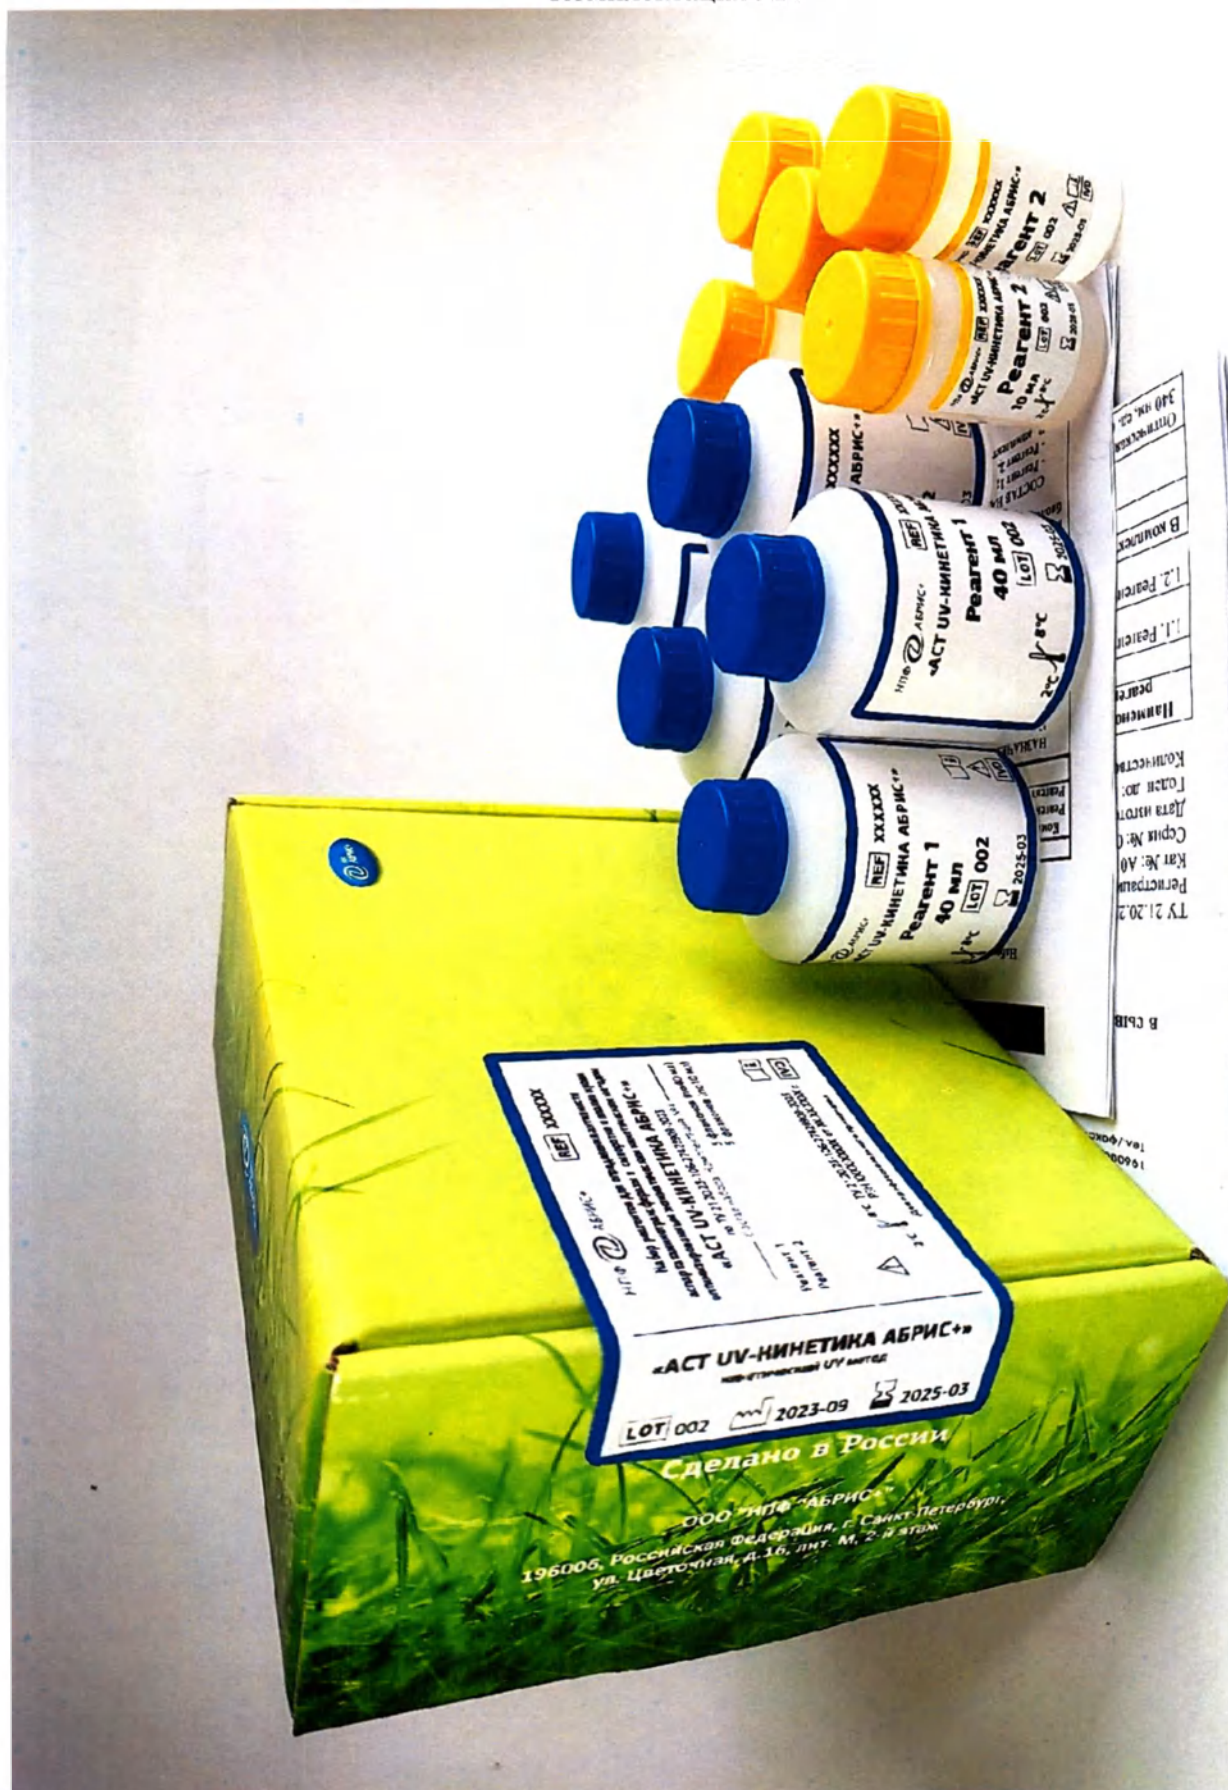


Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023


Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №4

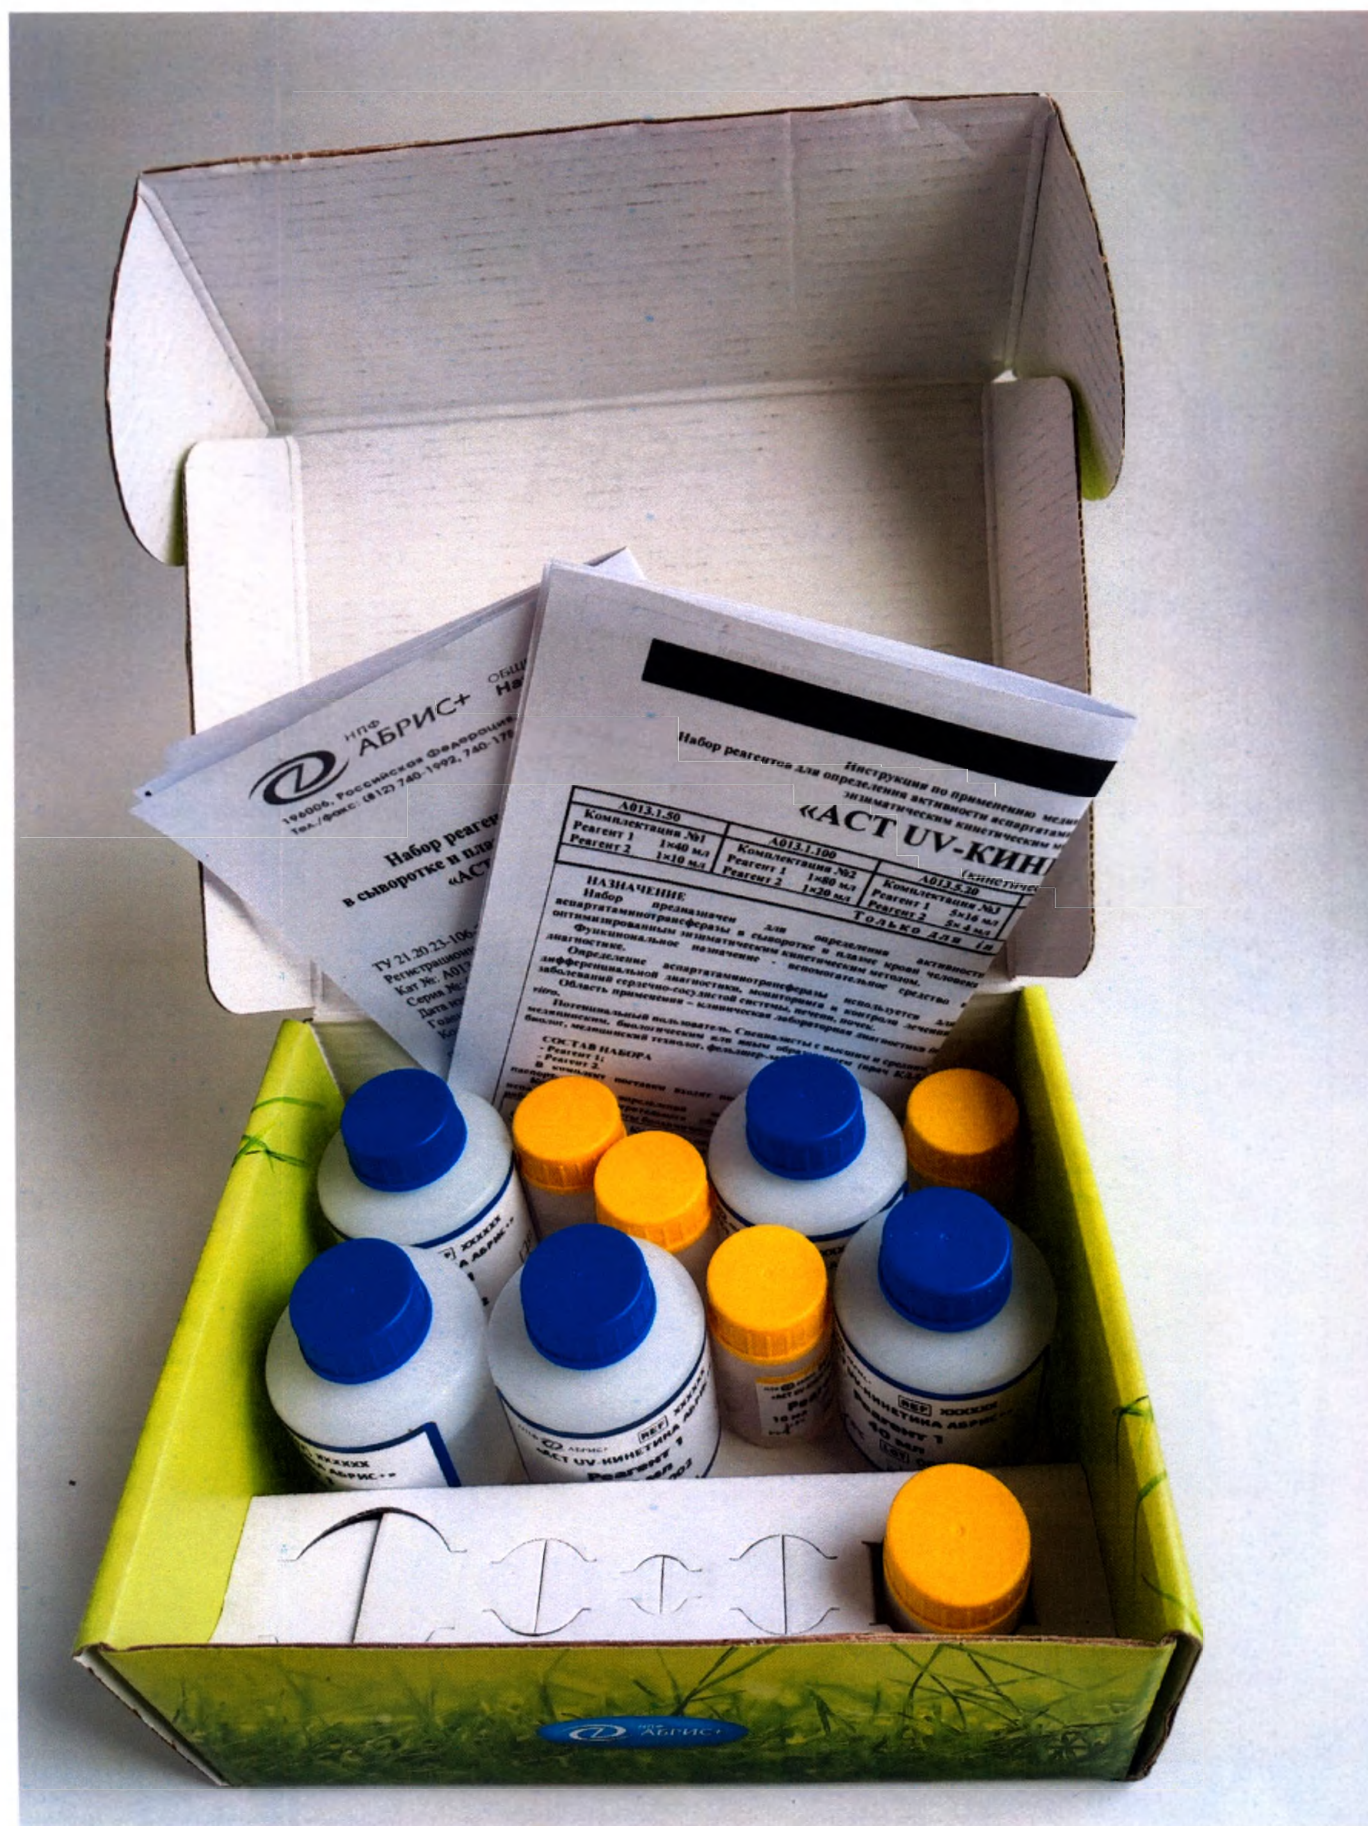

Комплектация №5

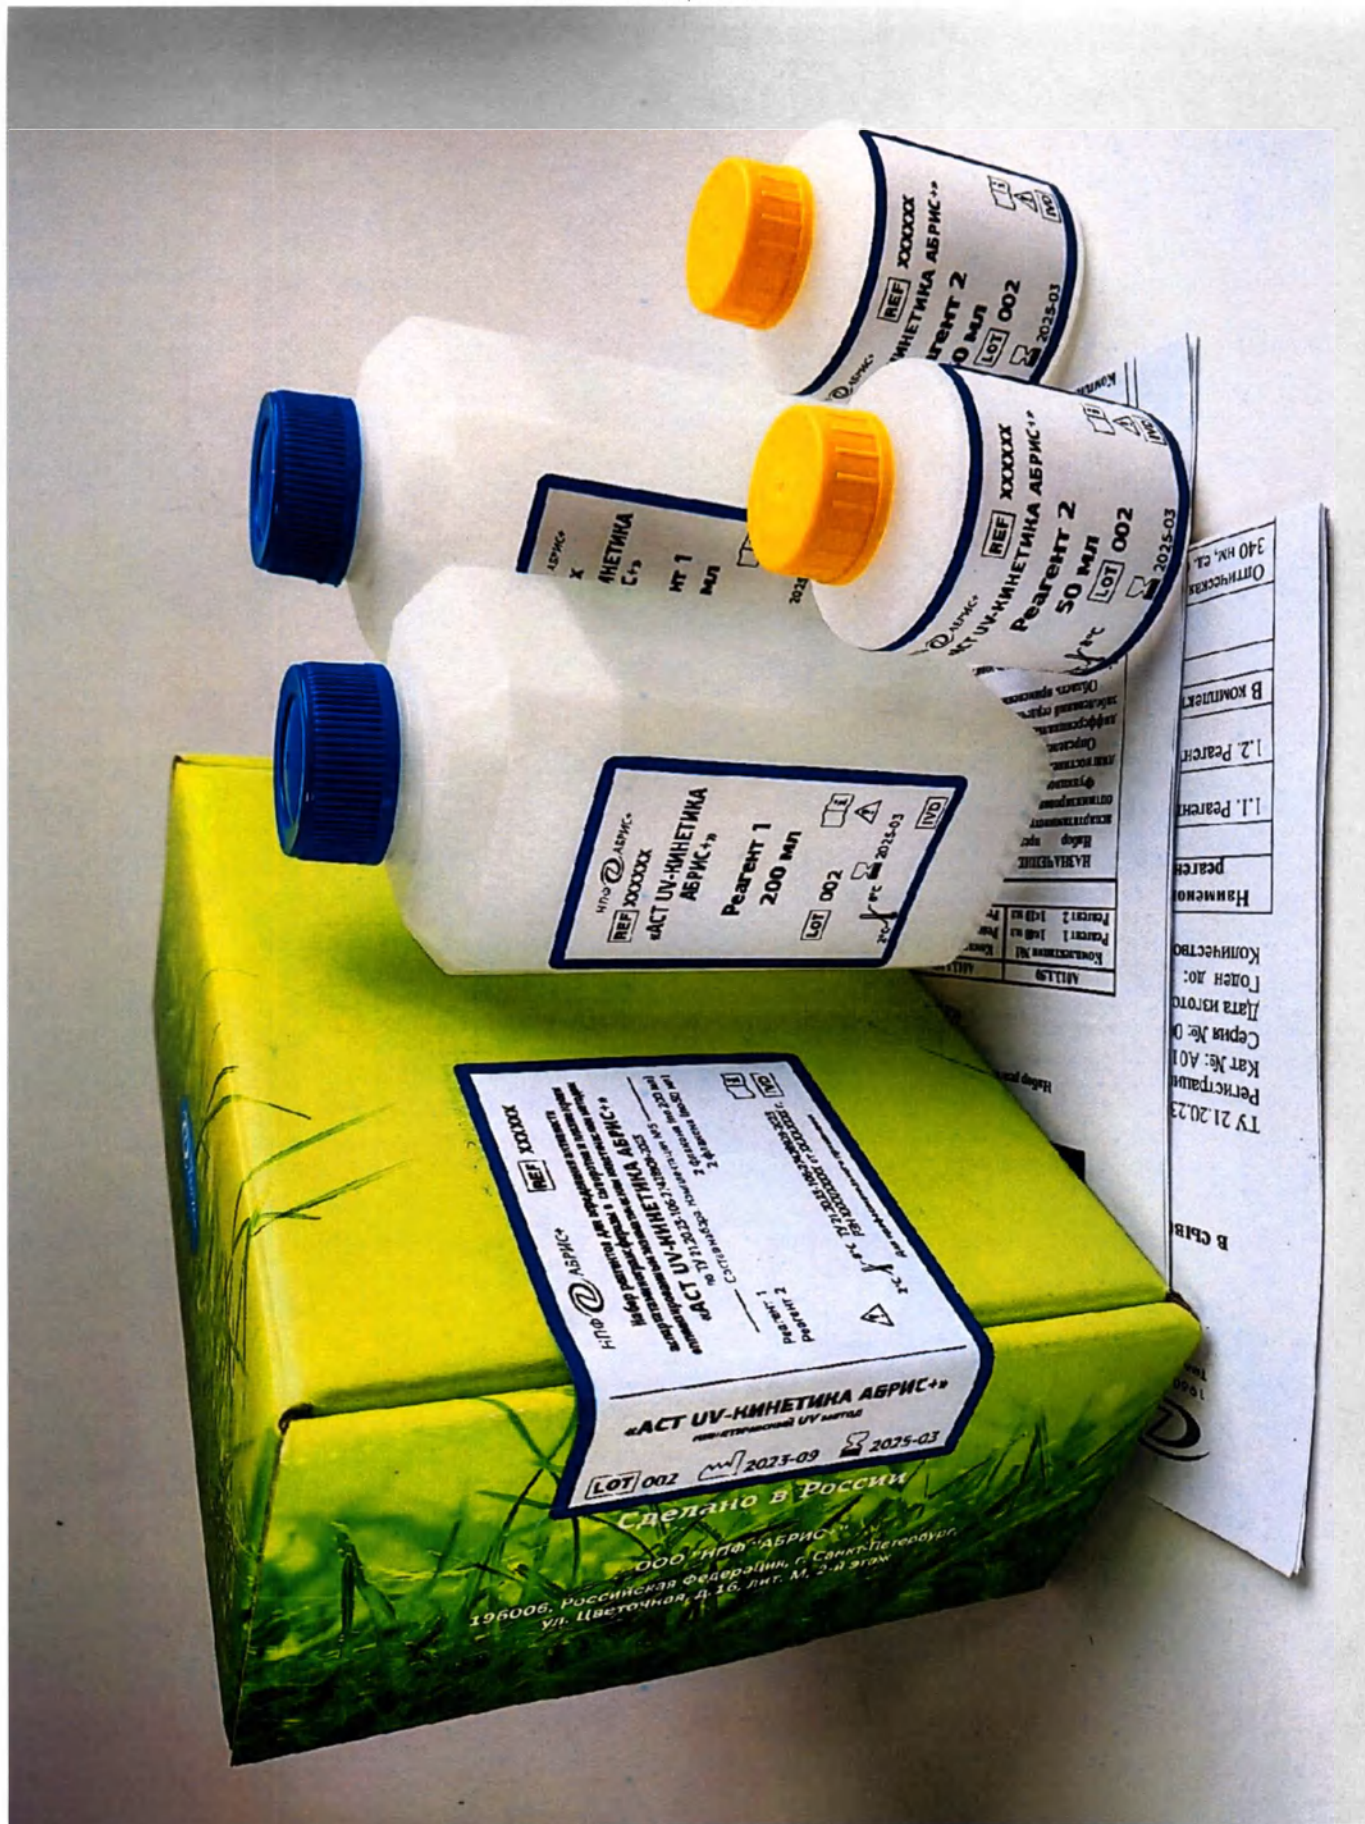

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №5



Комплектация №6




Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №6

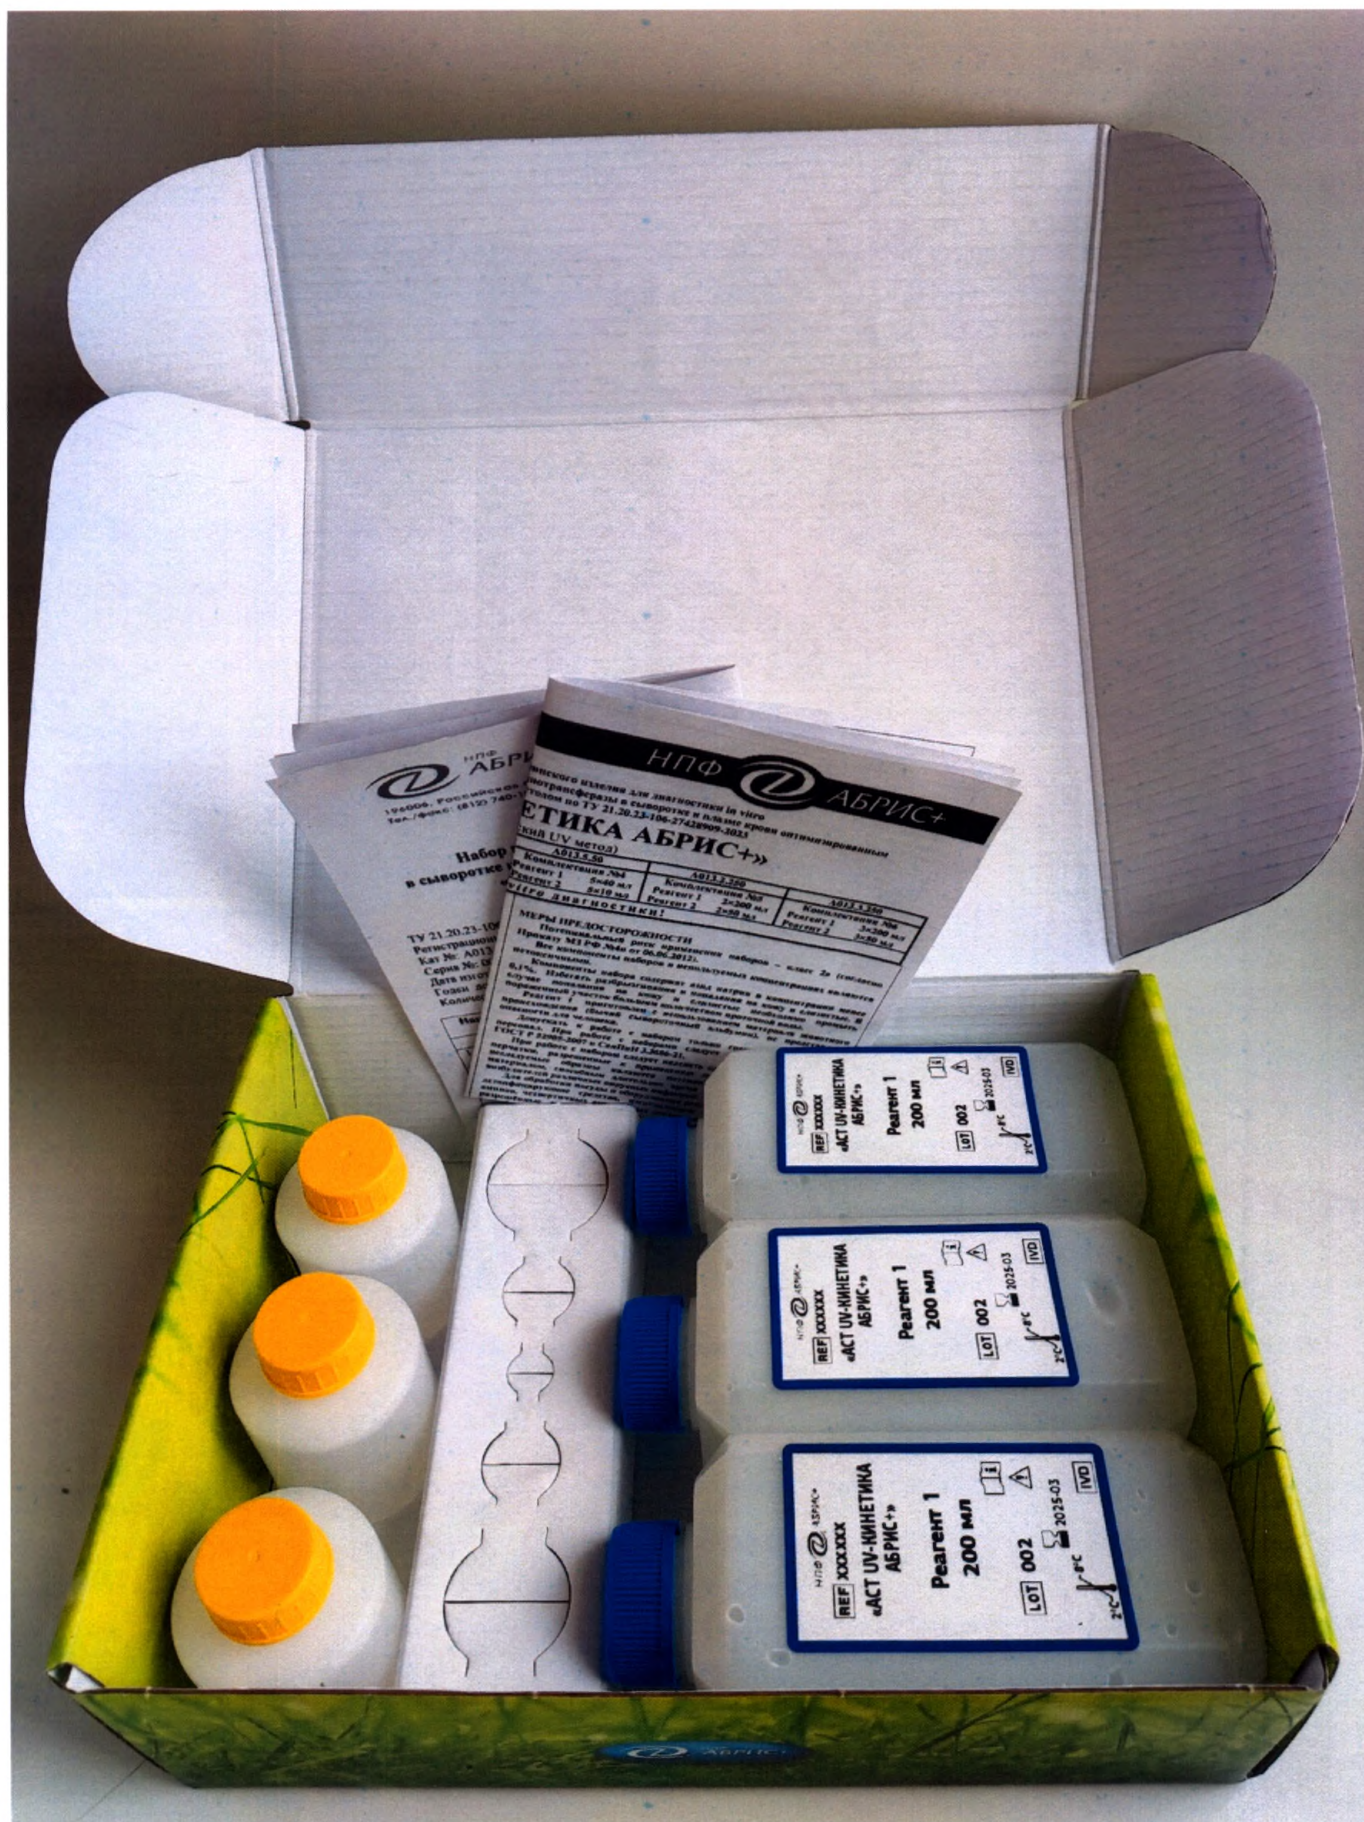


Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023


Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №7

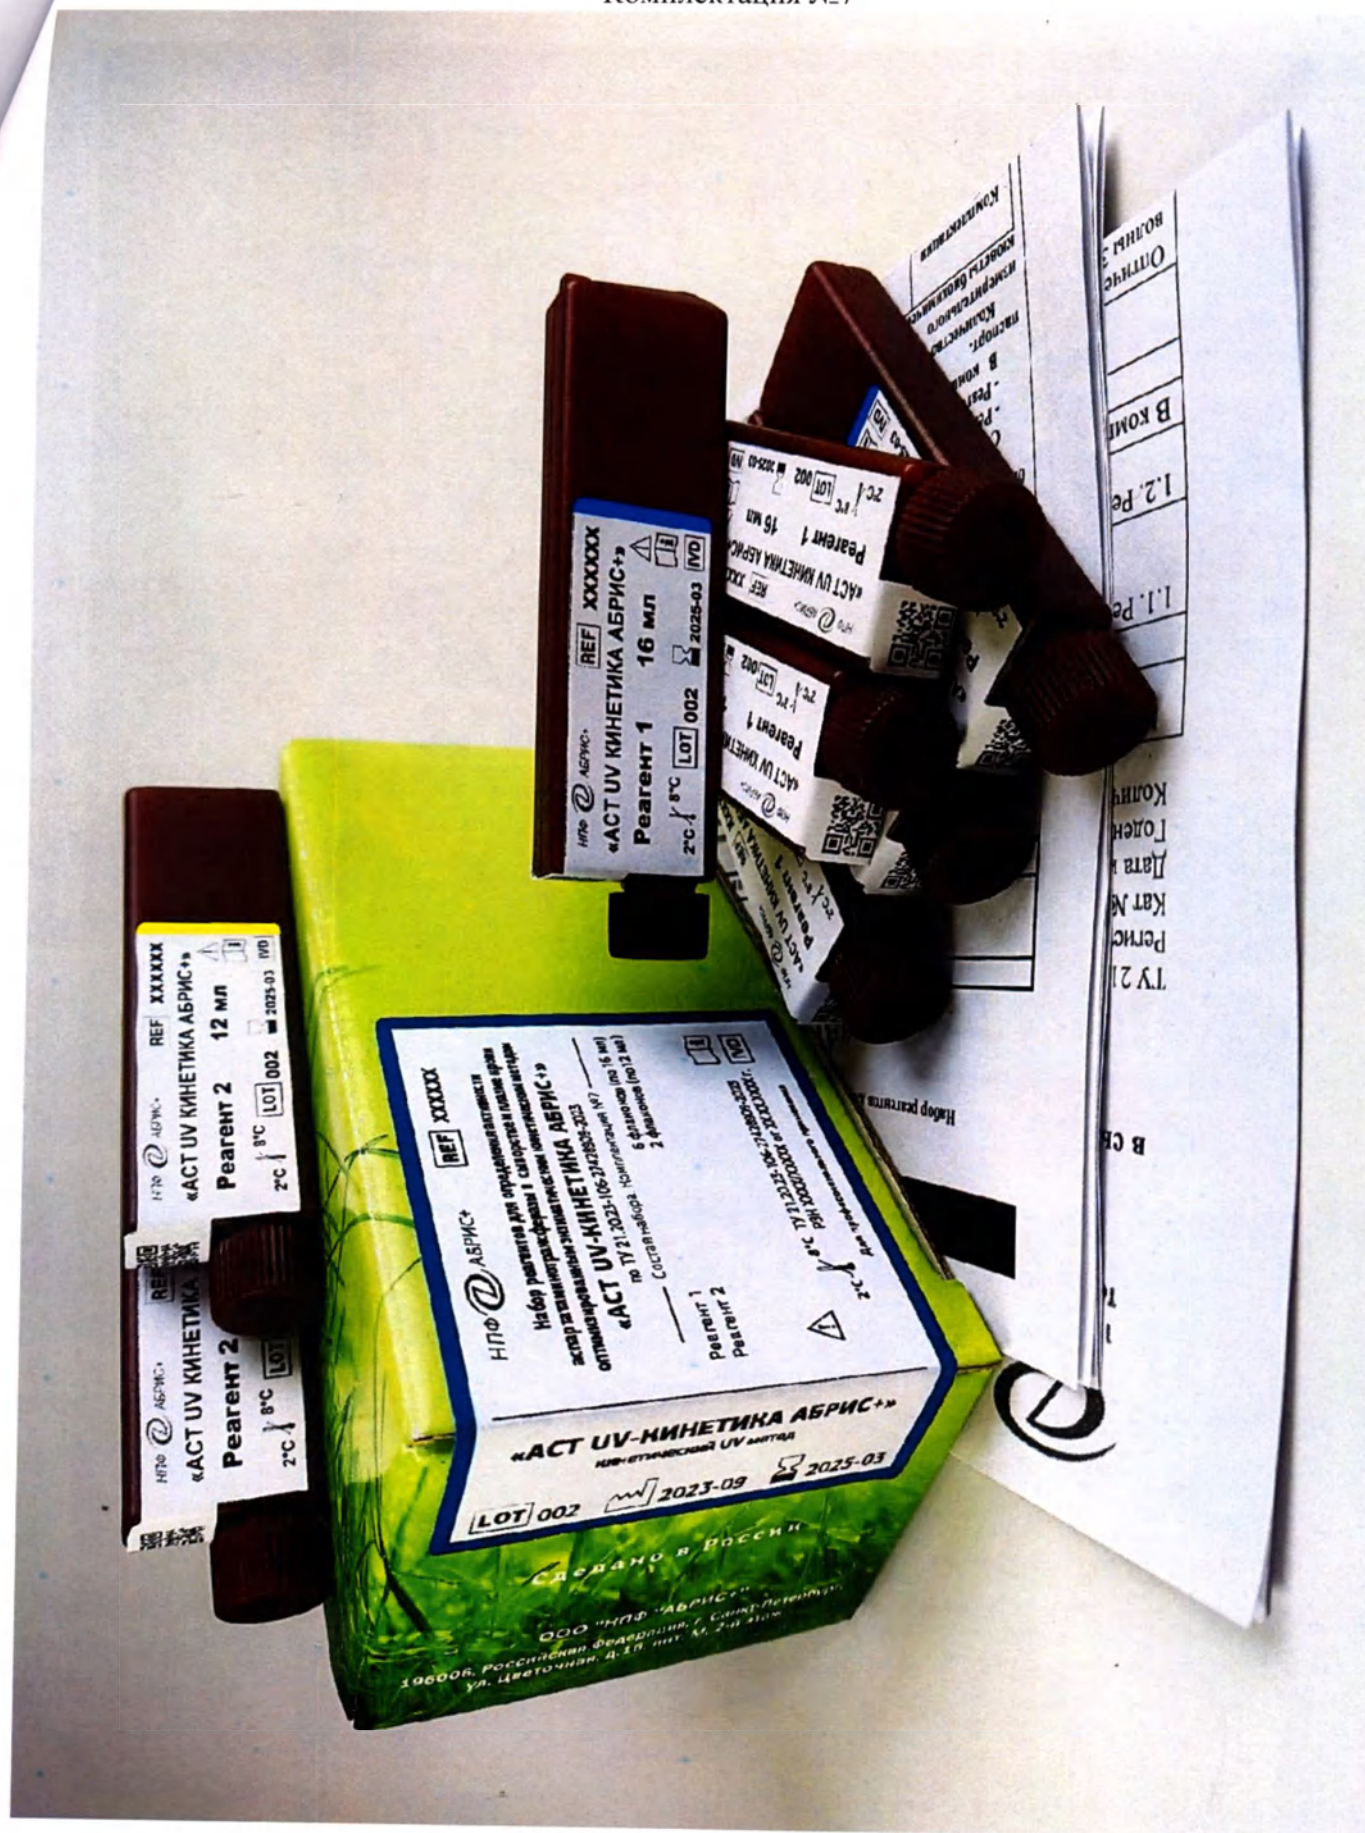

Комплектация №7

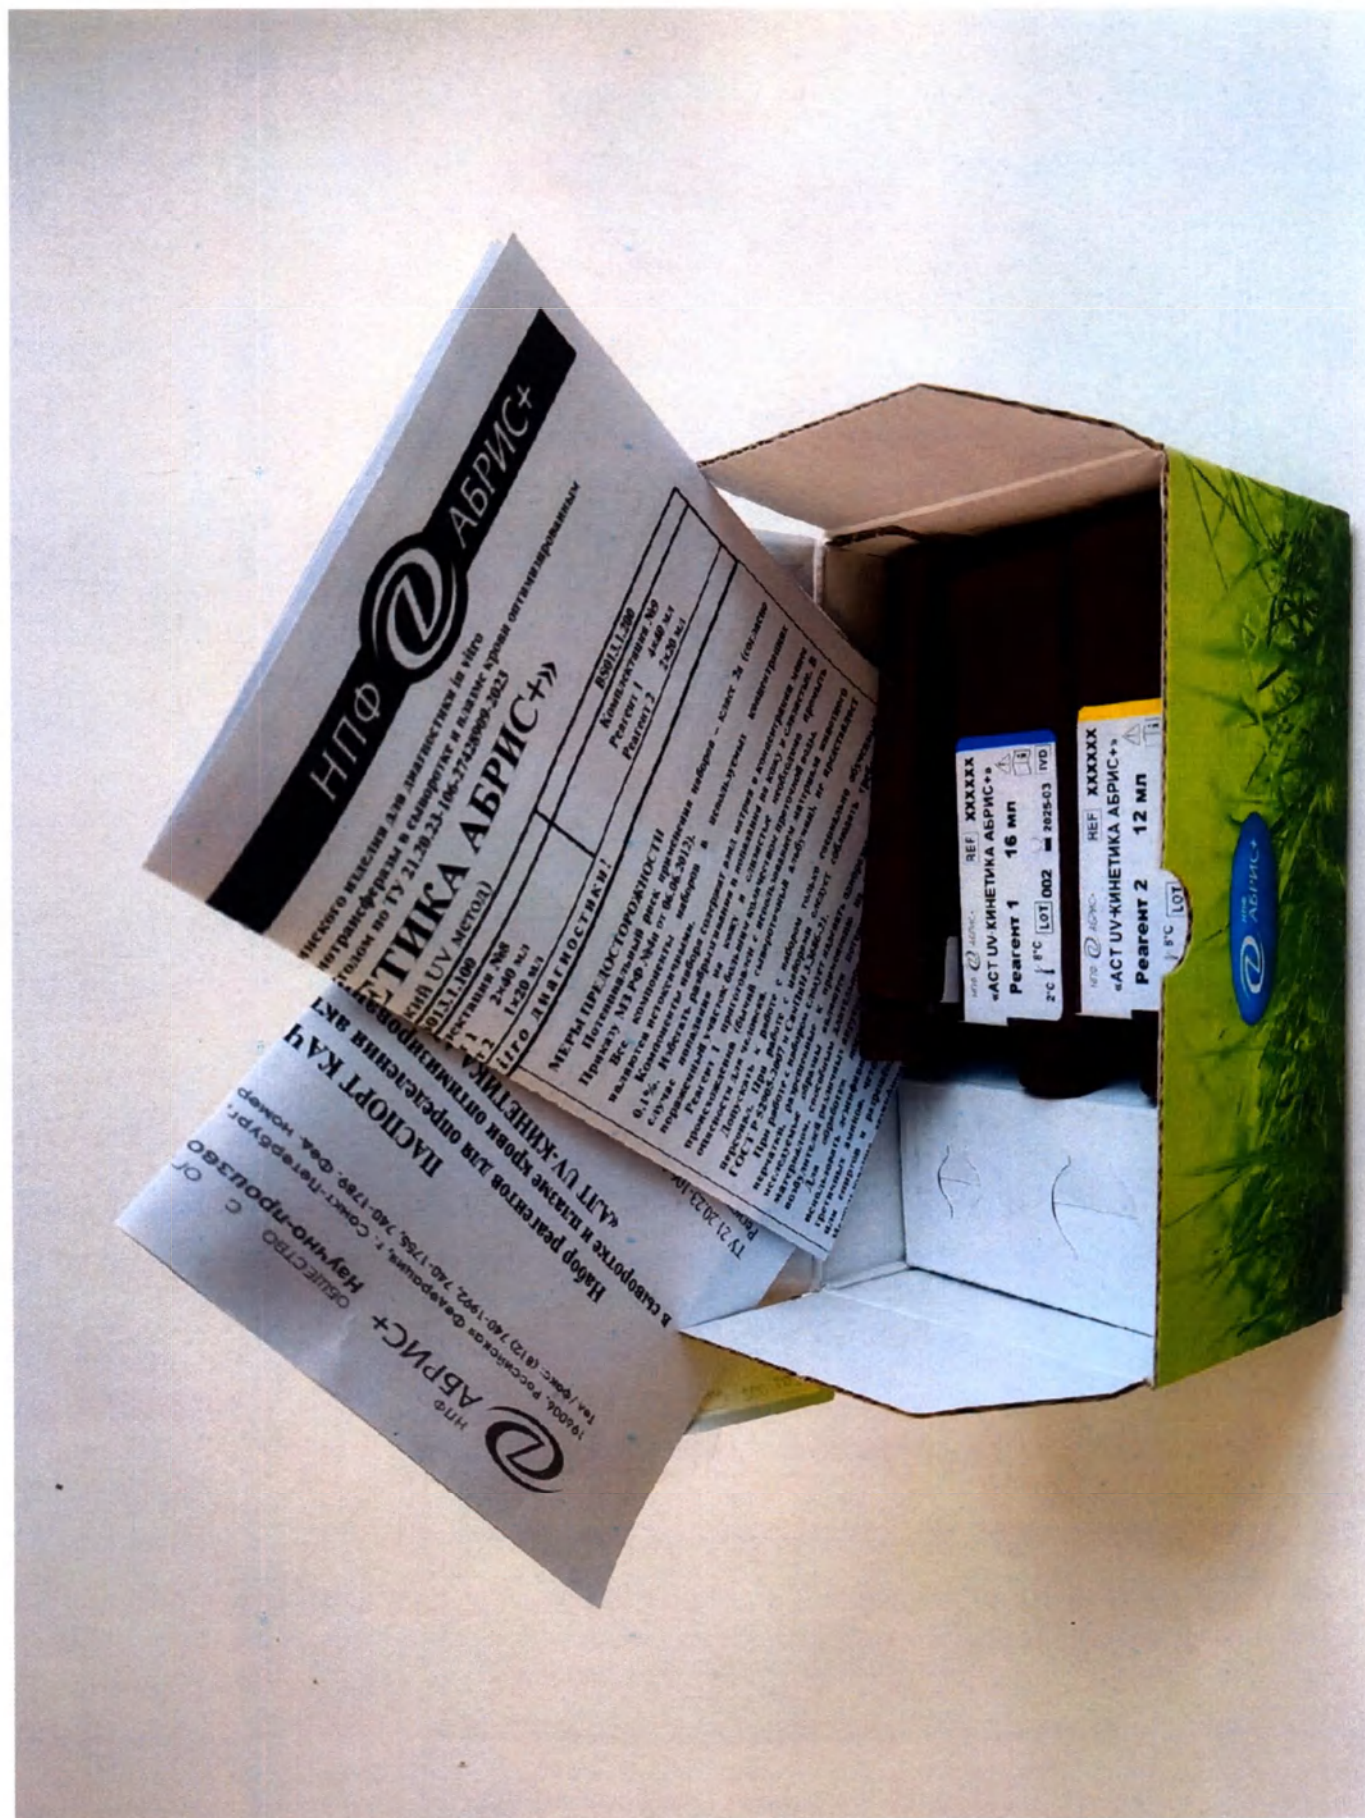


Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №8

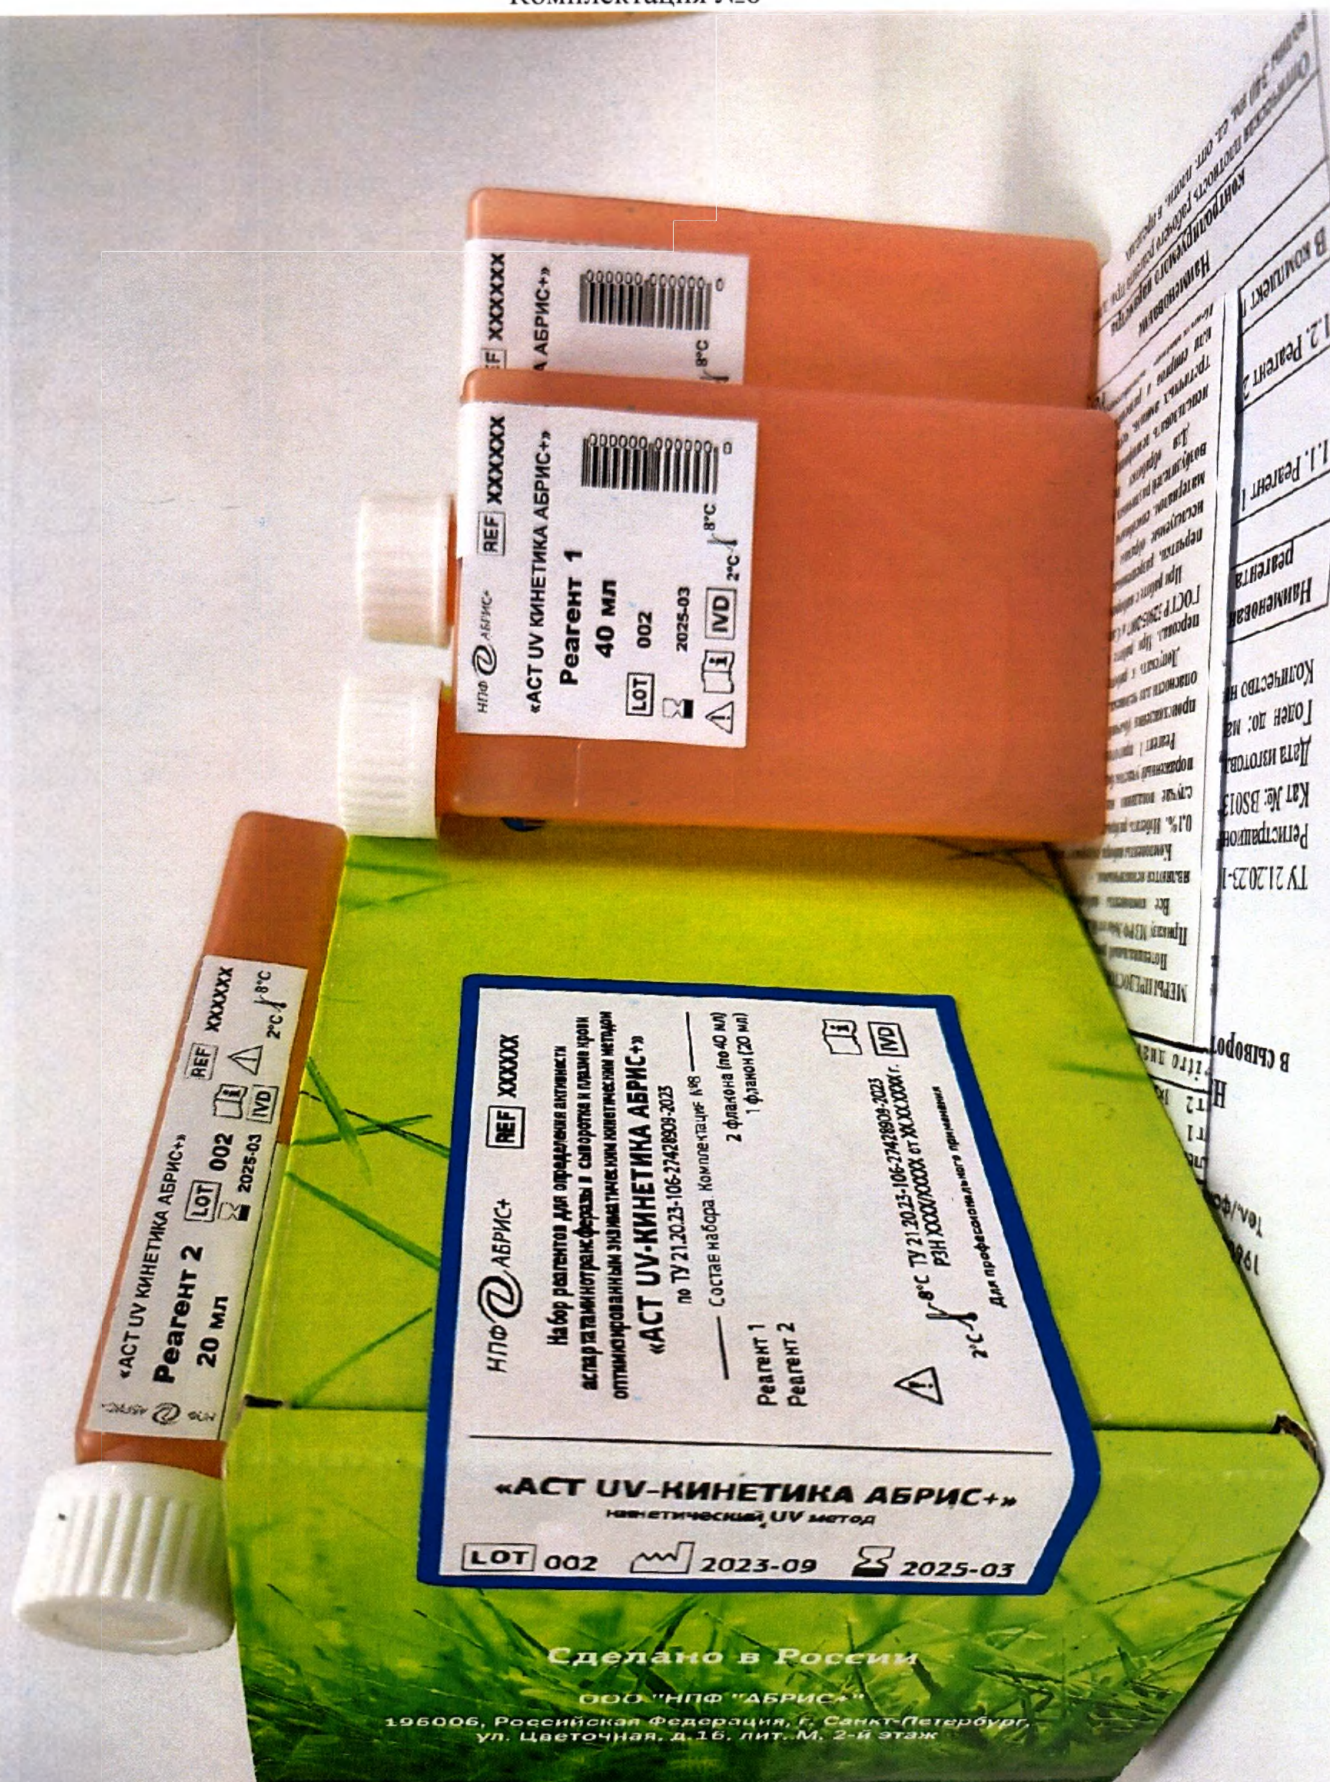


Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023


Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №8

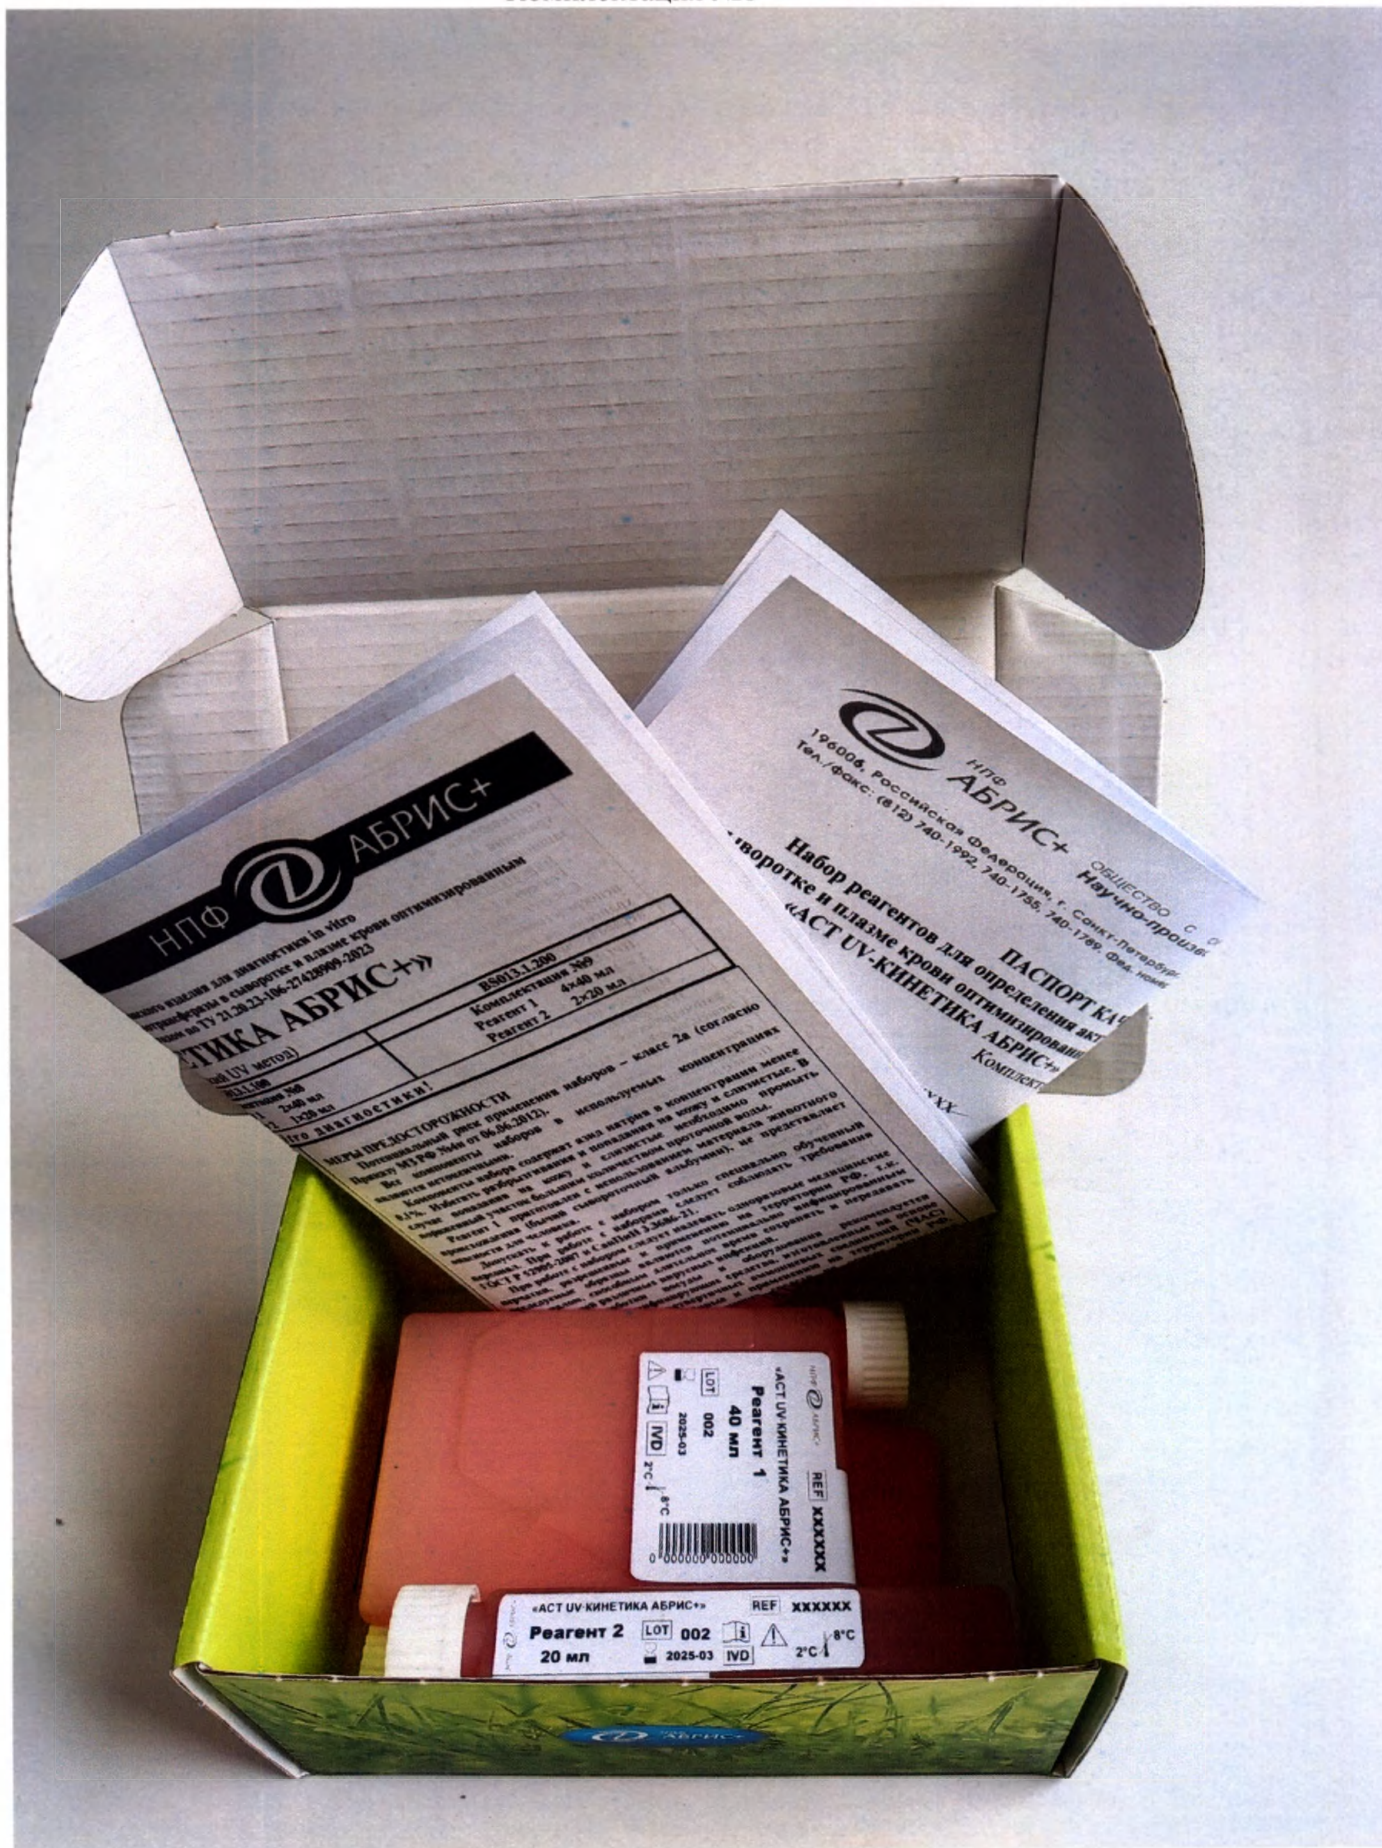

Комплектация №9

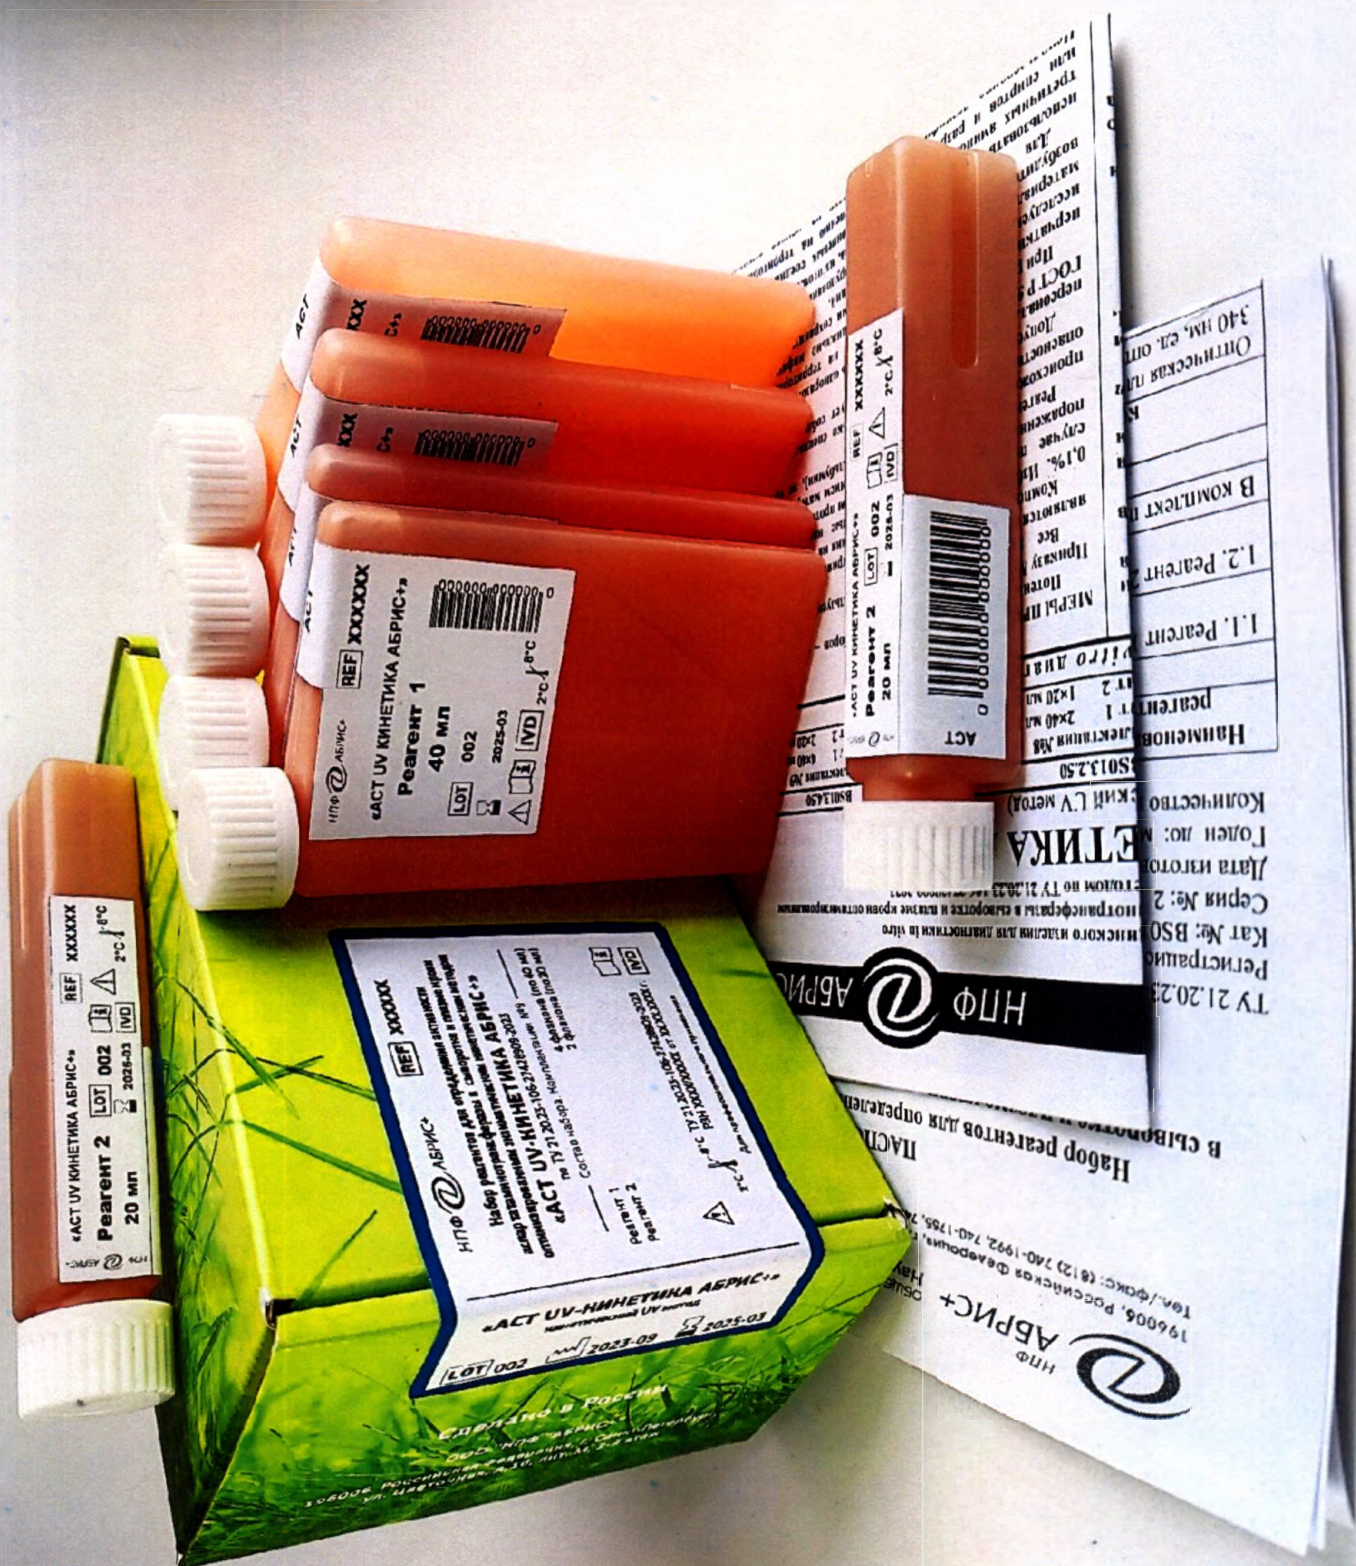

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №9



Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом «АСТ UV-КИНЕТИКА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-106-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №10



Комплектация №10



Прошито и пронумеровано

21 августа 2021 лист

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

