

PHILIPS

Менеджер по нормативному
регулированию ООО «ФИЛИПС»

Град А.А.

2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями»


Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями, в вариантах исполнения: Ingenia Elition S, Ingenia Elition X



1. Магнит.

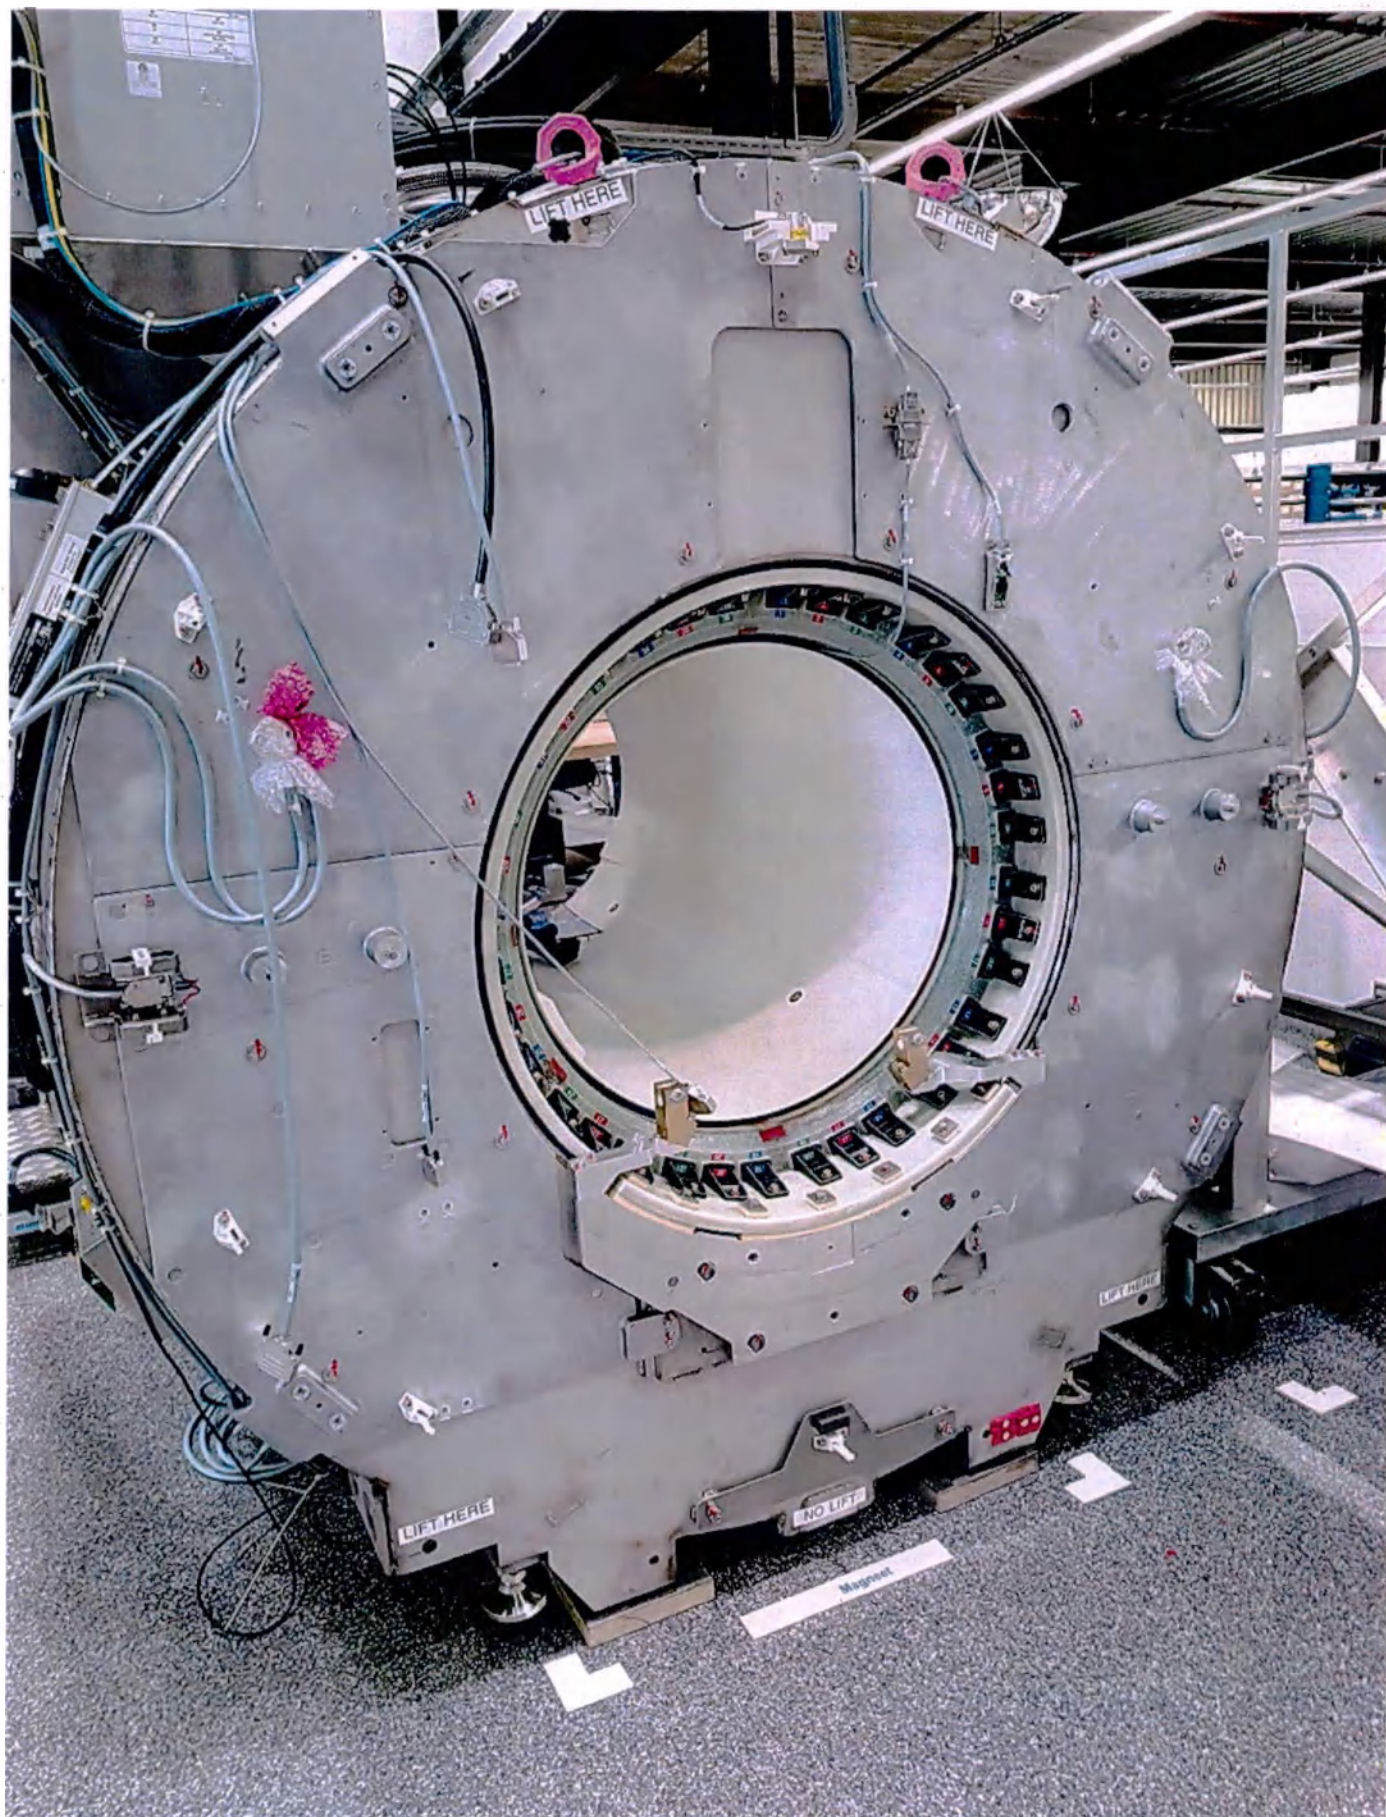


2. Градиентная система. Градиентная катушка в магните.

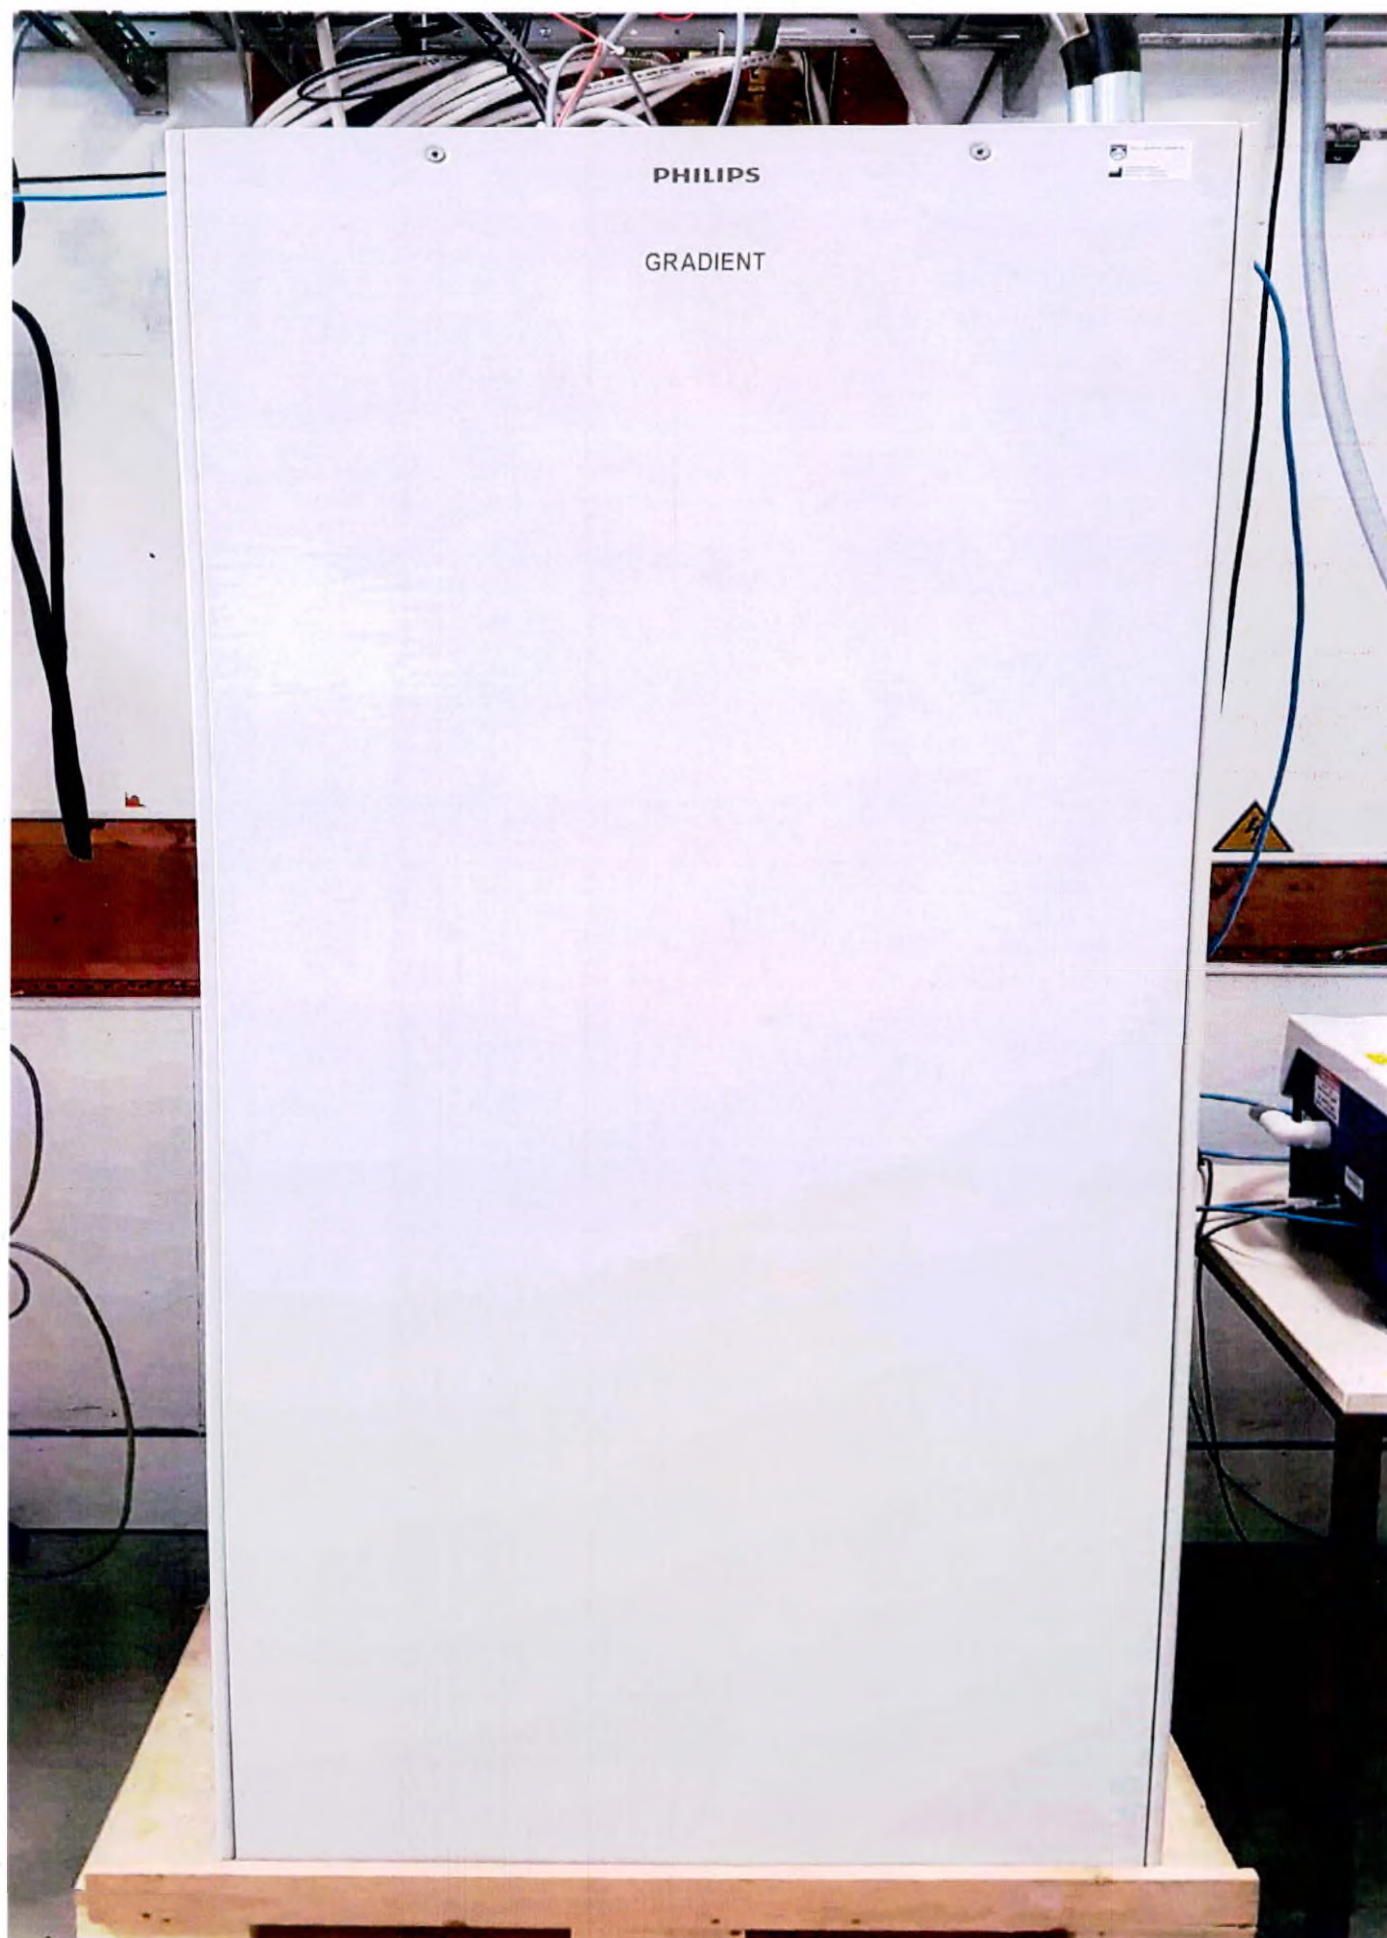

2. Градиентная система. Градиентный усилитель. Вид 1.



2. Градиентная система. Градиентный усилитель. Вид 2.

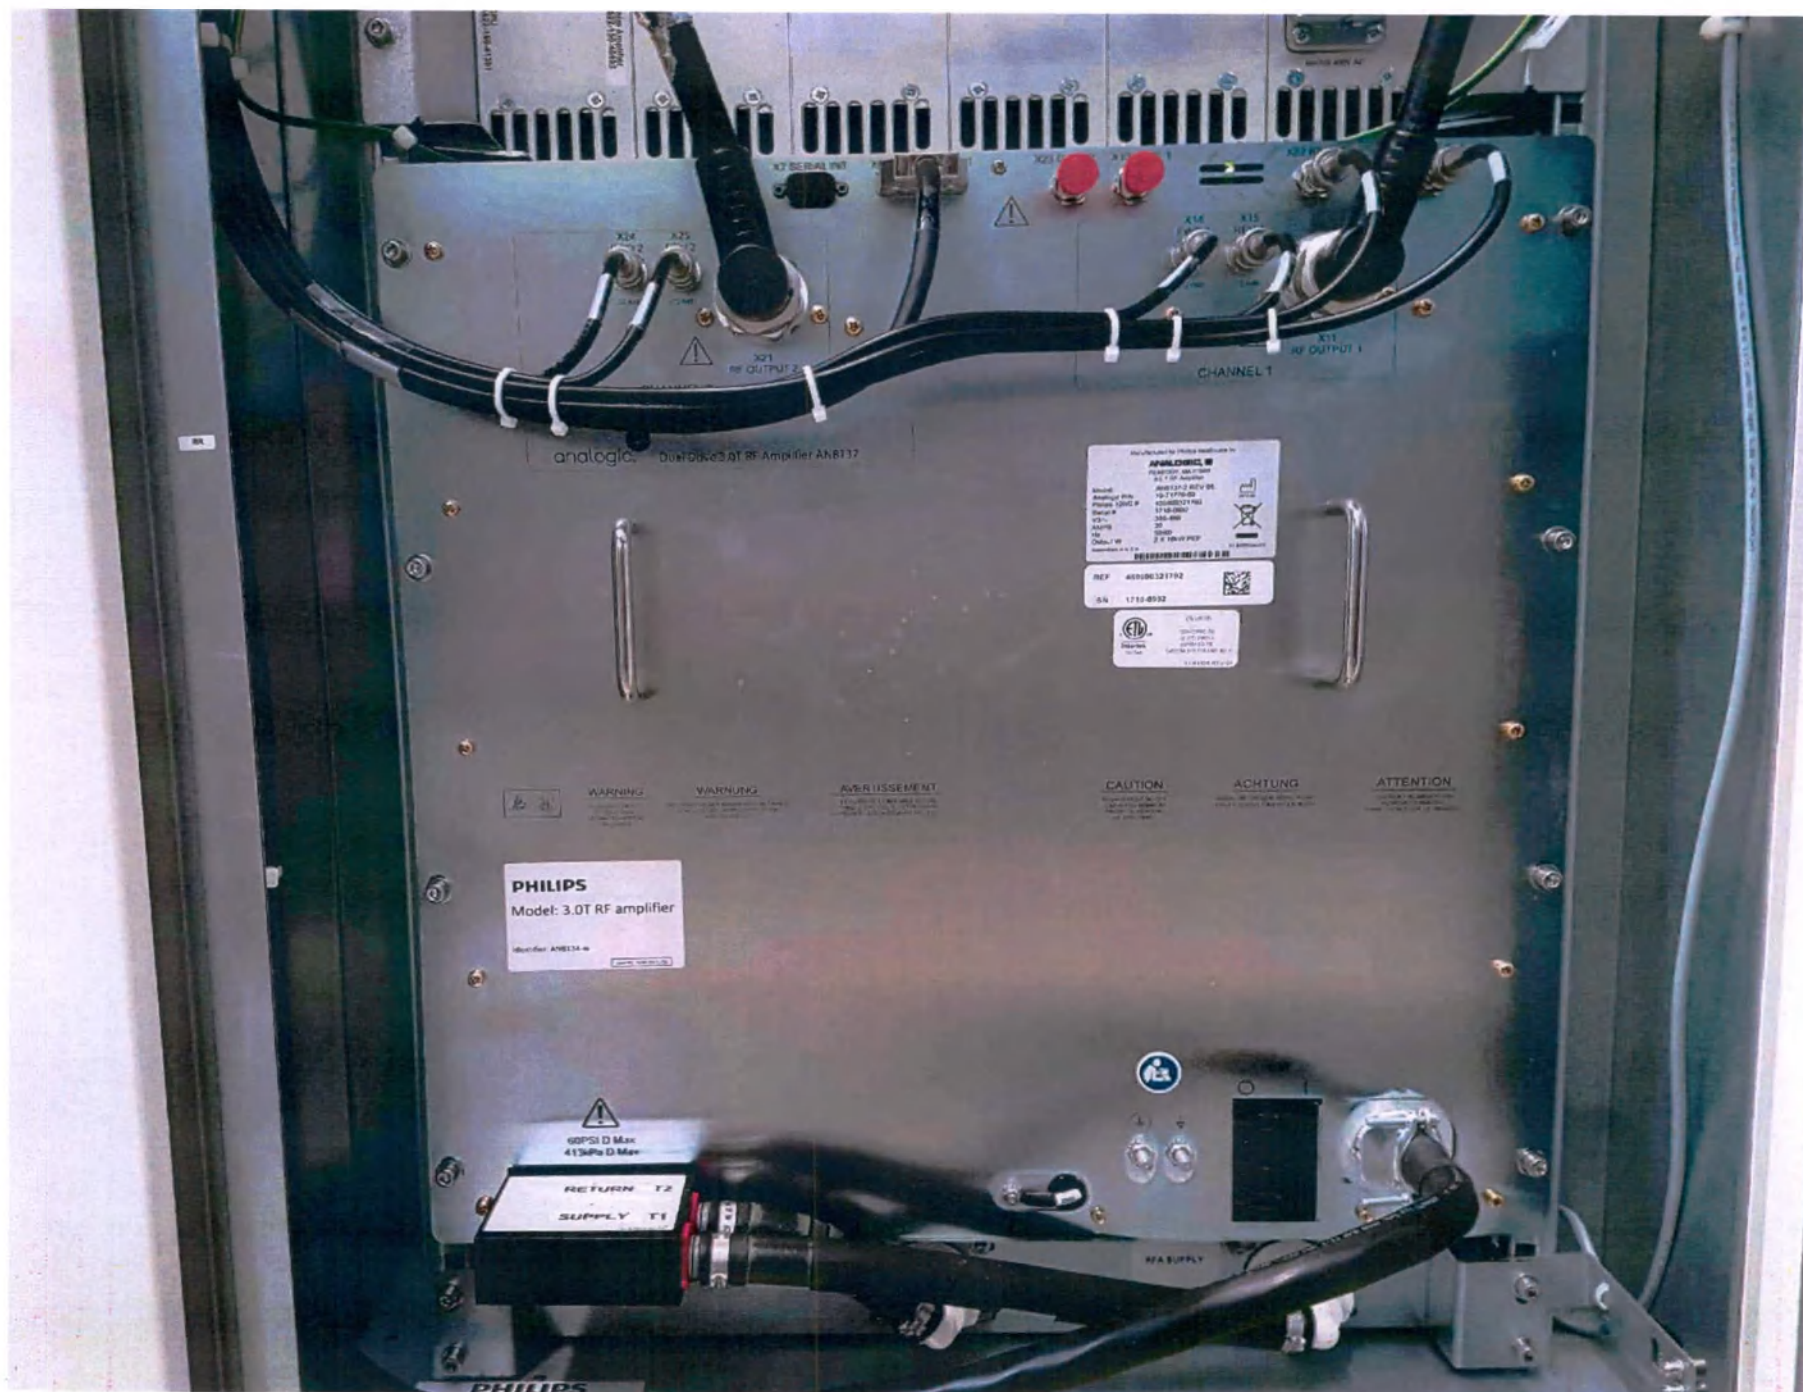

3. РЧ-усилитель.



4. Стол пациента.



5. Дека стола.

6. РЧ-катушки (при необходимости):




6.1. Катушка dS Base.




6.2. Катушка dS Head.




6.3. Катюшка dS HeadNeck.

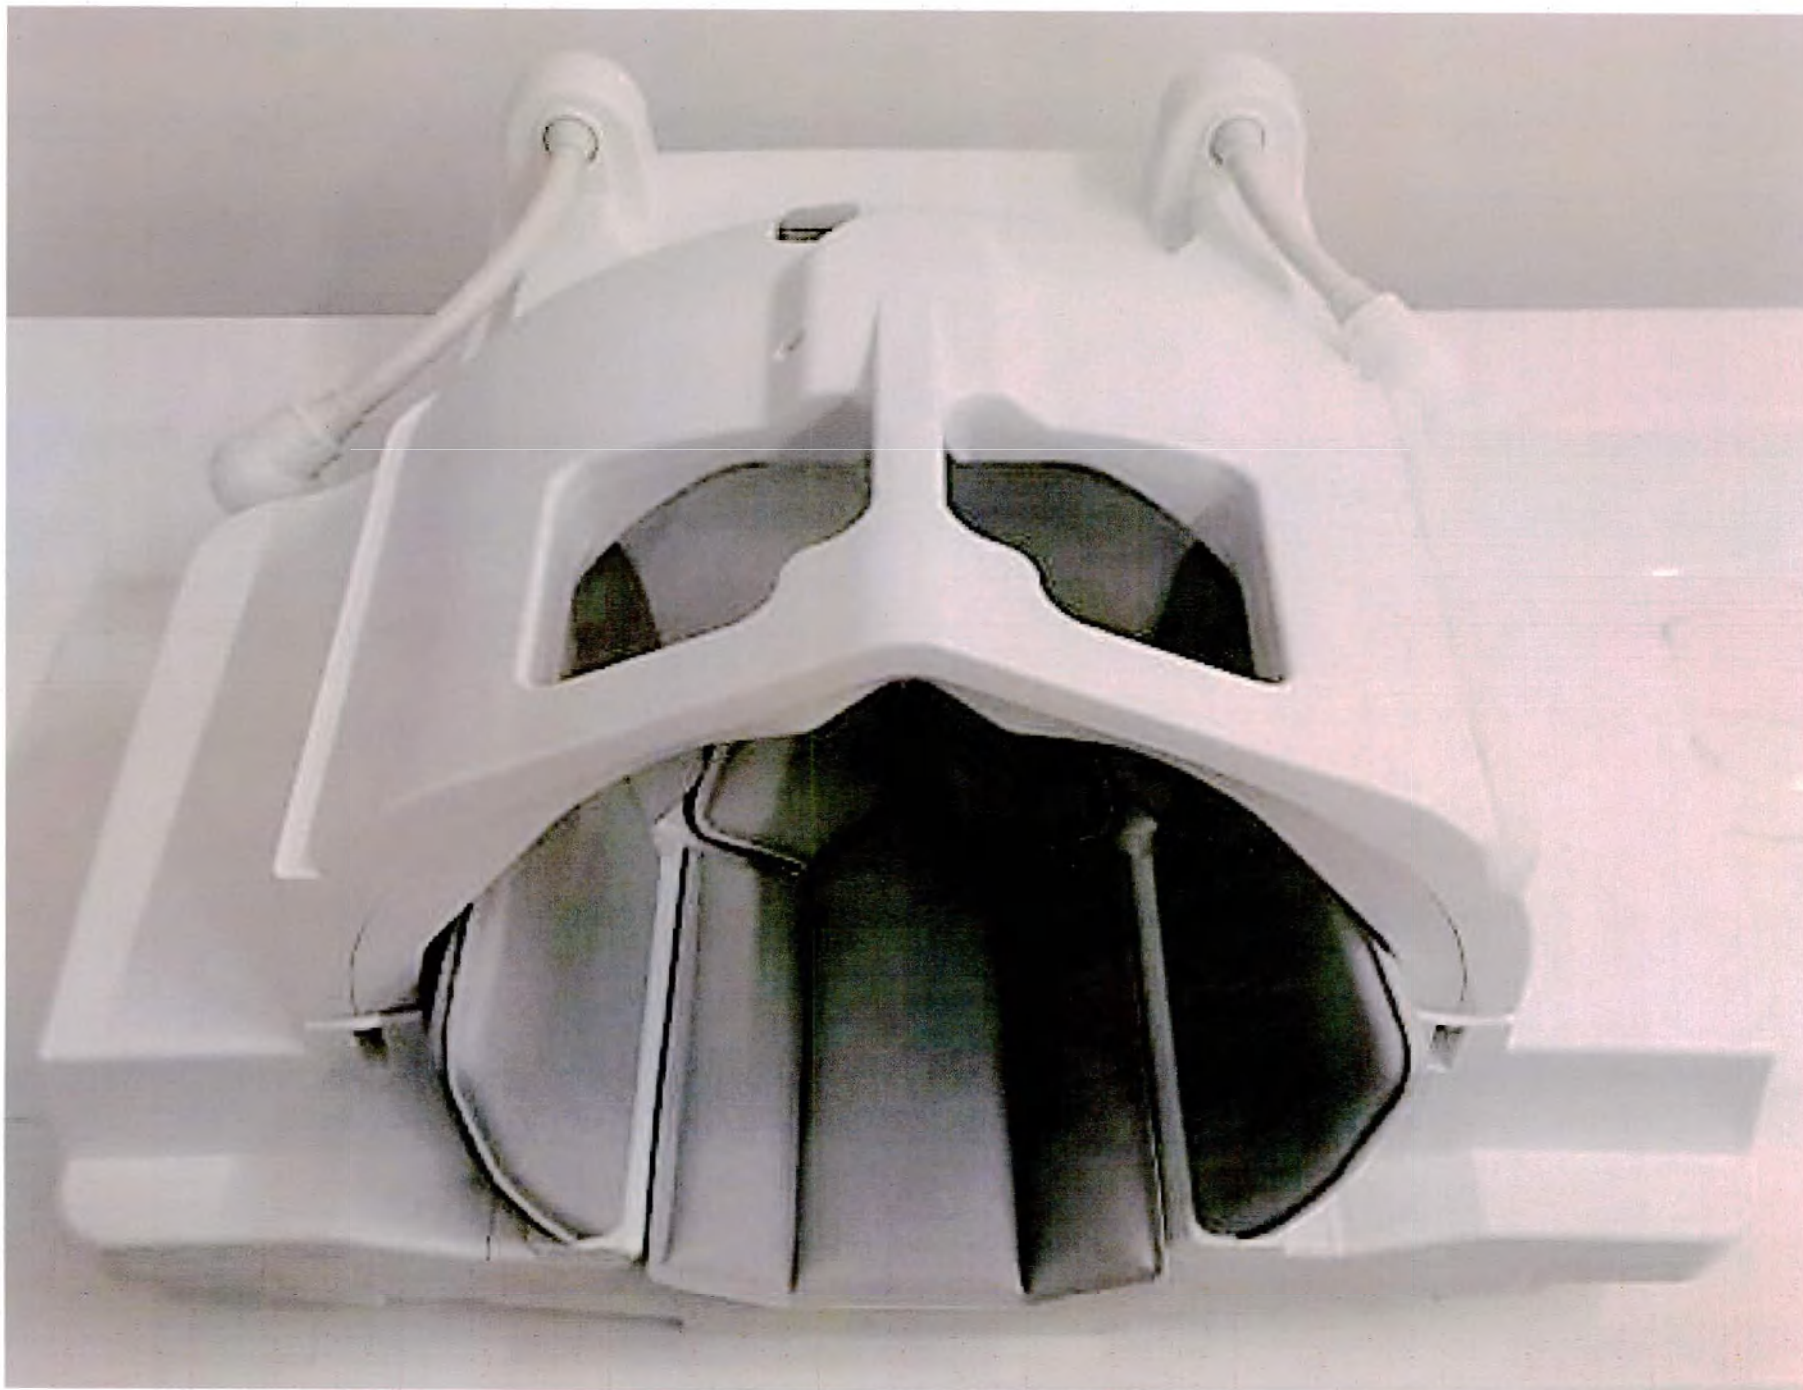


6.4. Катушка dS Head 32ch 3.0 T.

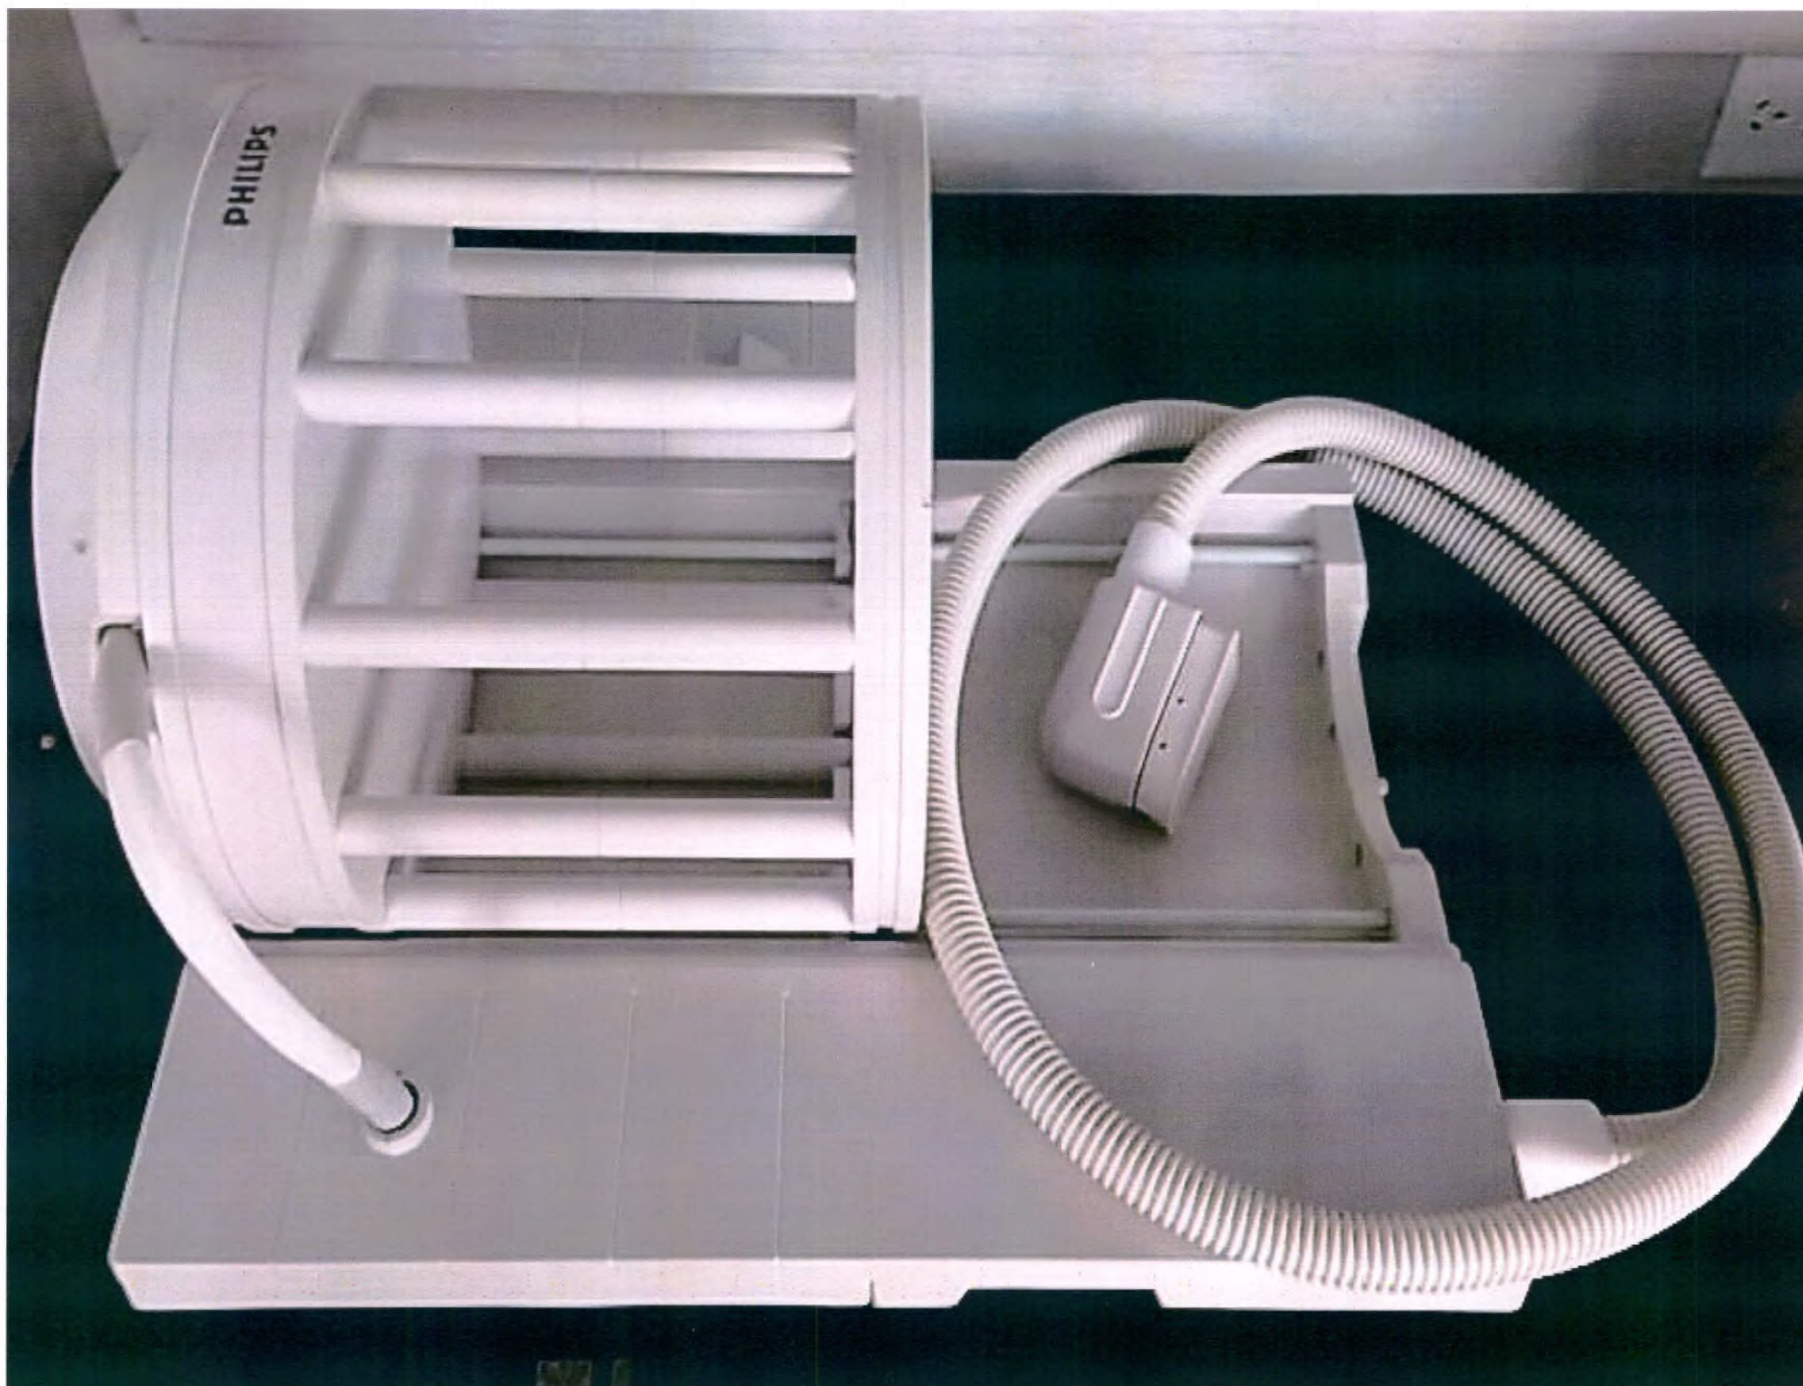

6.5. Катушка T/R Head.

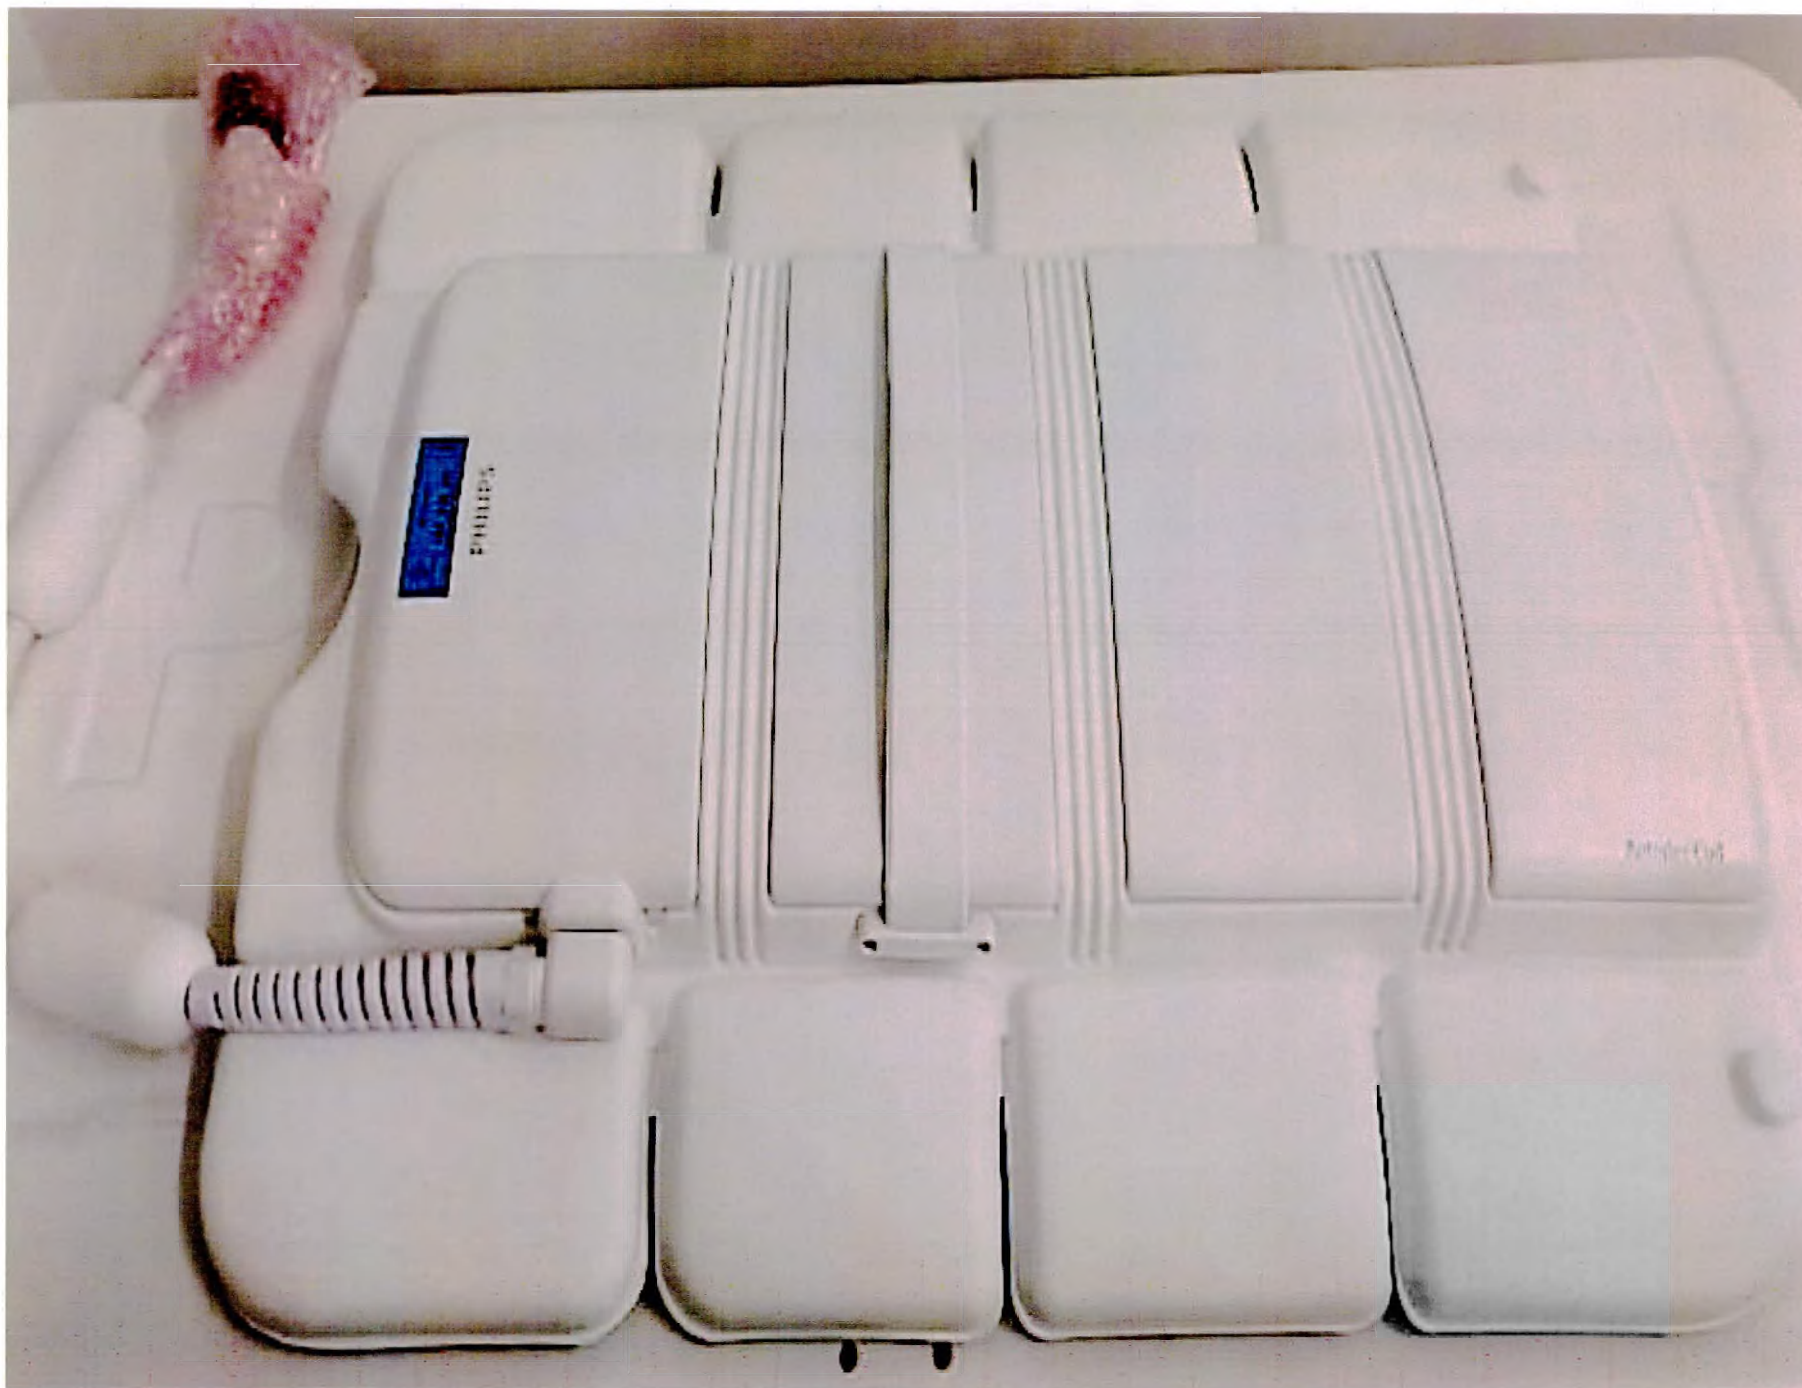


6.6. Катушка dS Torso.

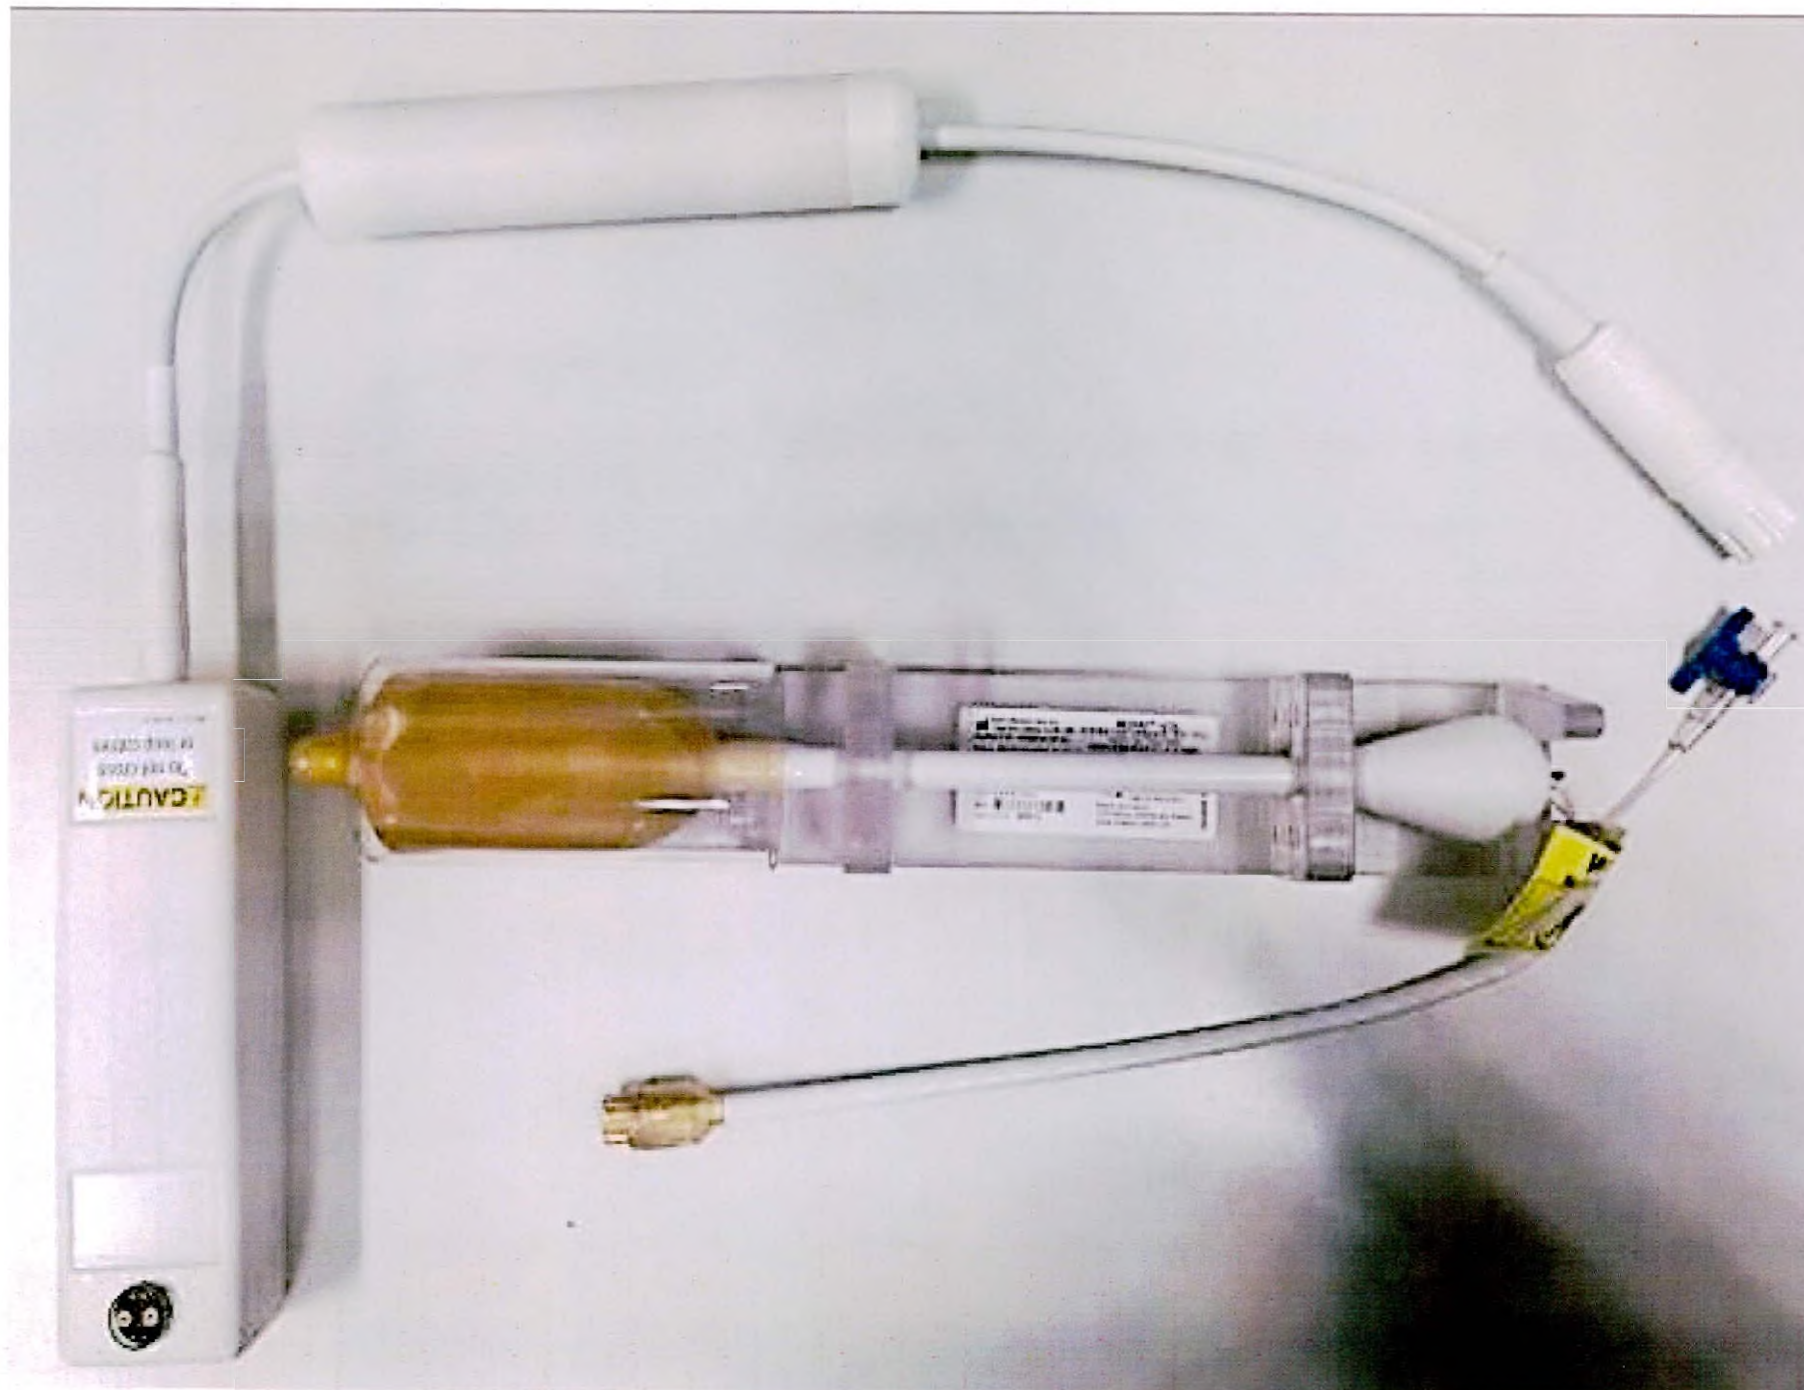


6.7. Катушка dS Endo 3.0T



6.8. 16-канальная катушка dS Breast.

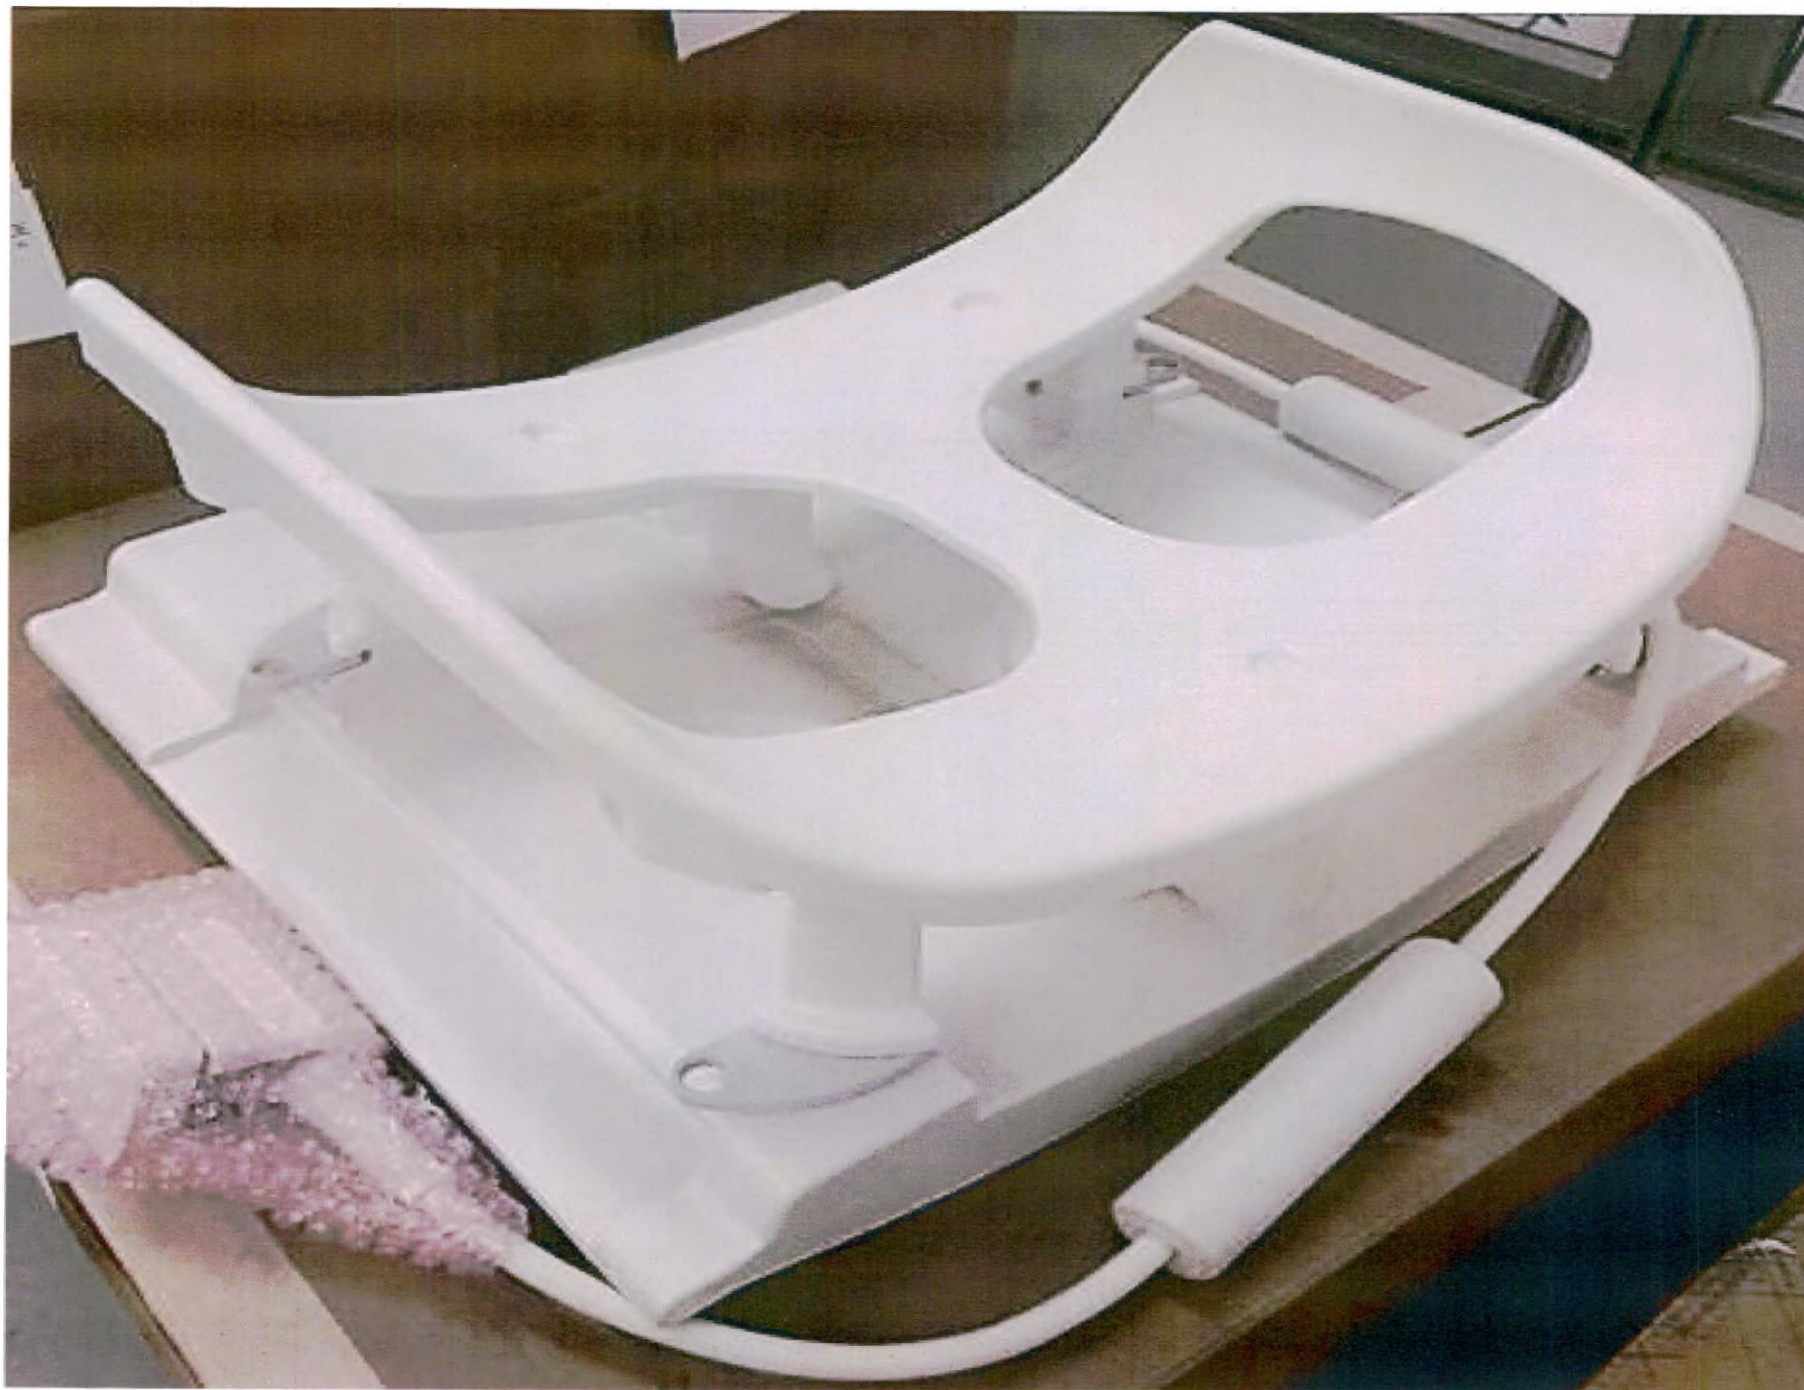


6.9. 7-канальная катушка dS Breast.

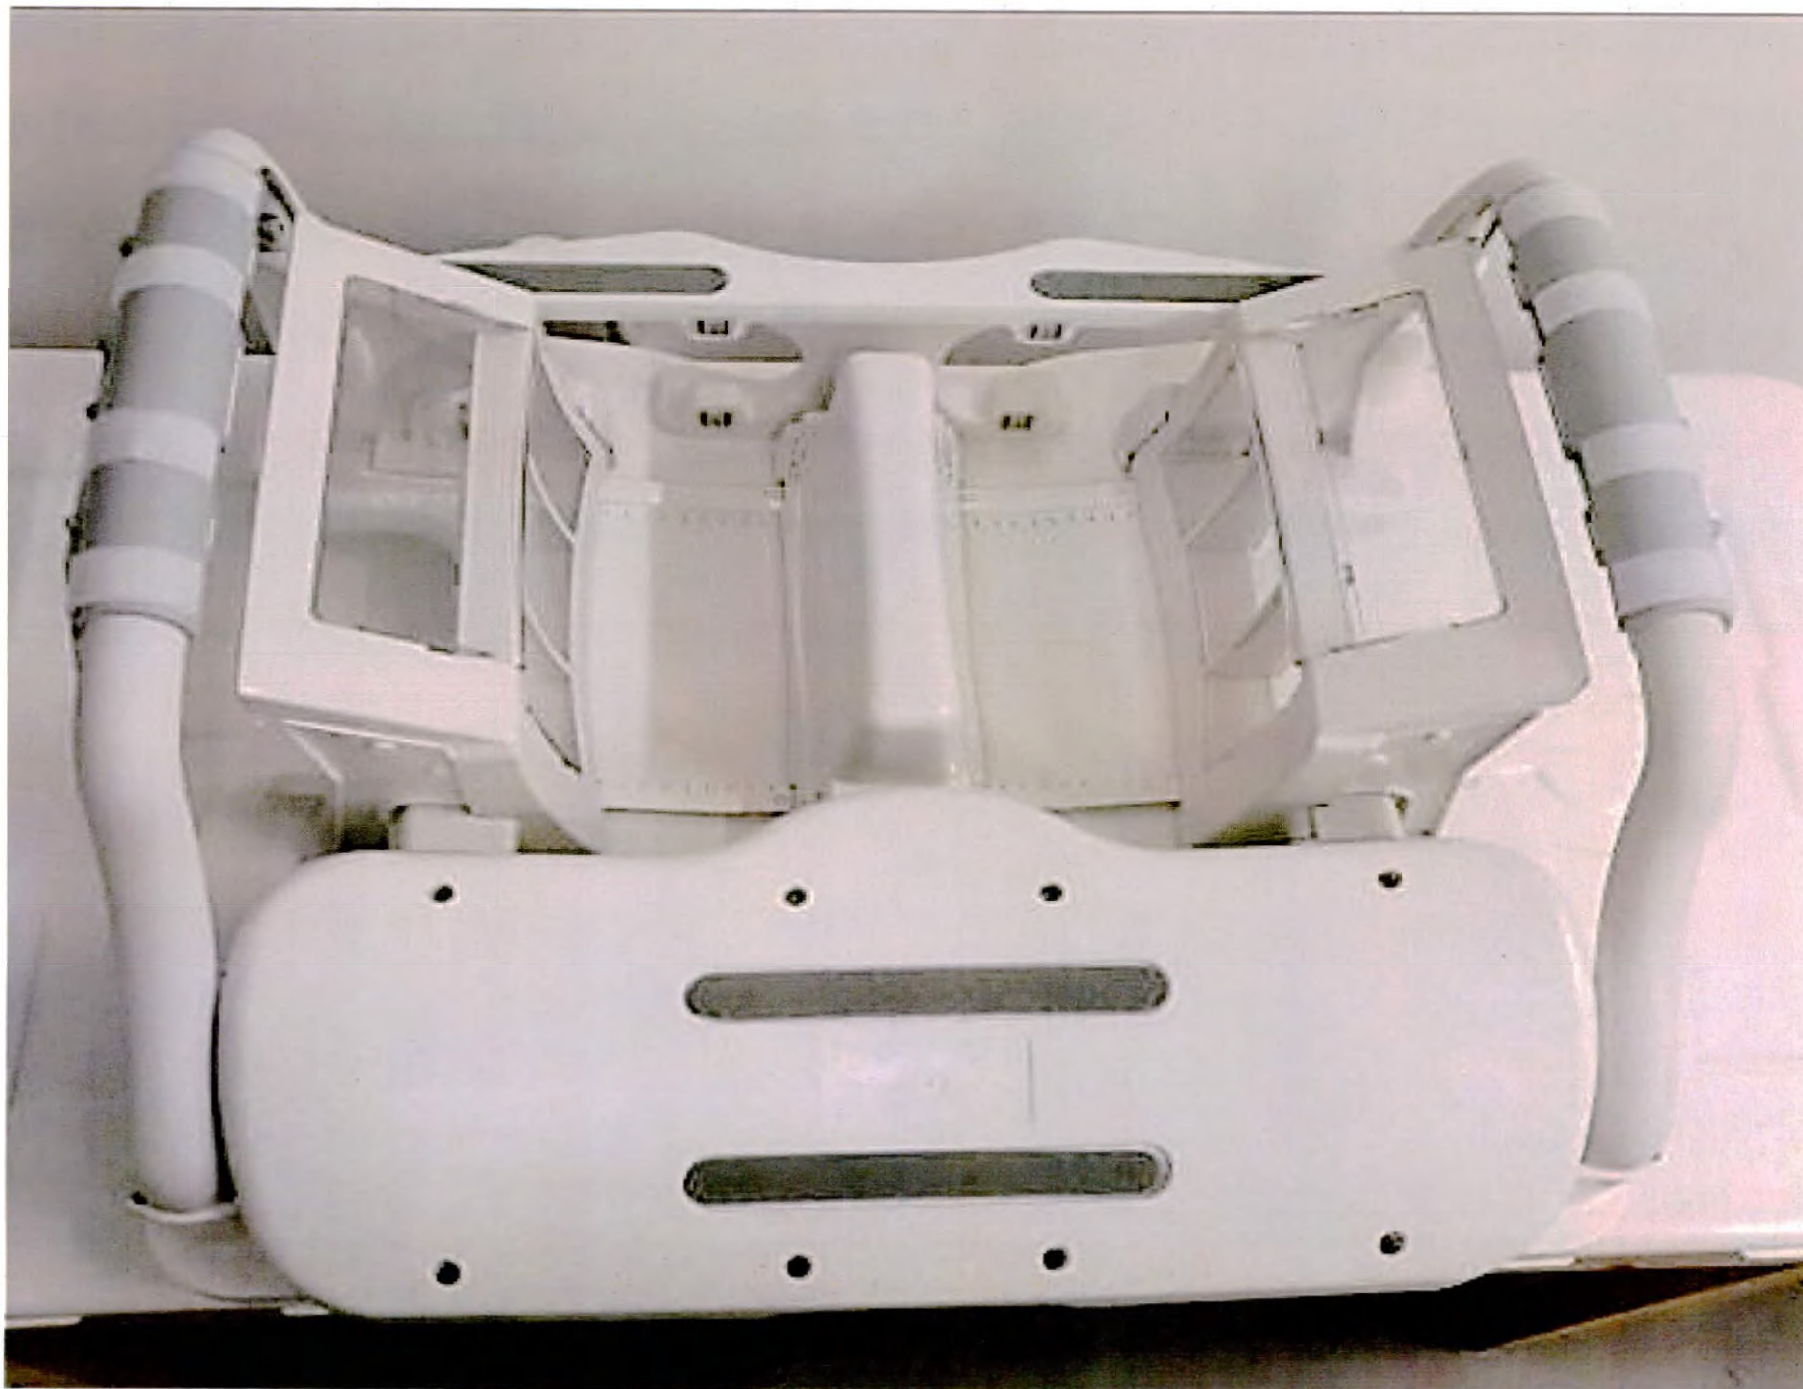

6.10. Катущка dS Breast Adaptive 16ch.



6.11. Катушка dS Flex S.

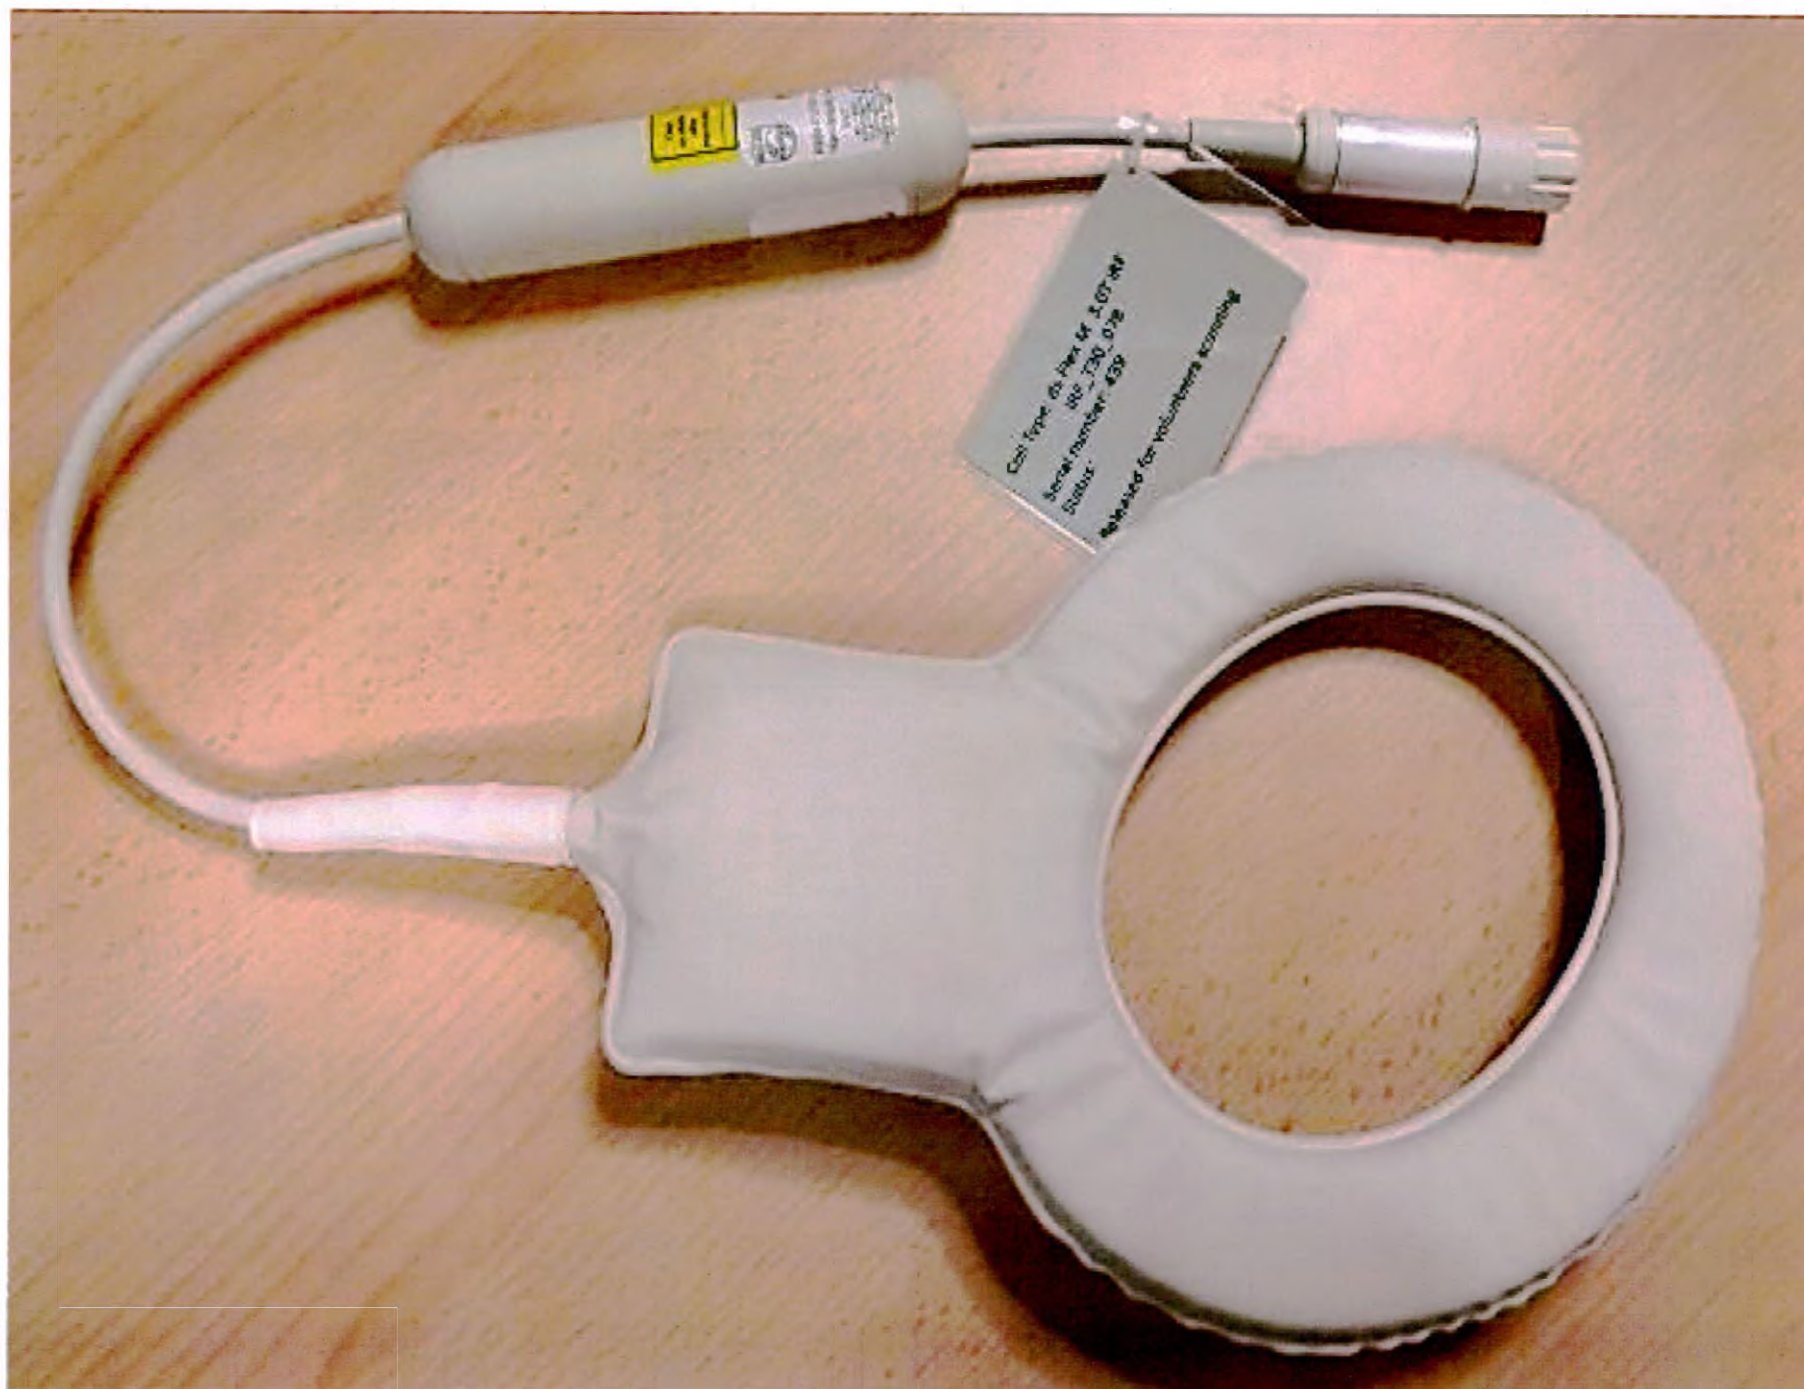


6.12. Катюшка dS Flex M.



6.13. Катюшка dS Flex L.




6.14. Катушка dS Shoulder 8ch. Вид 1.

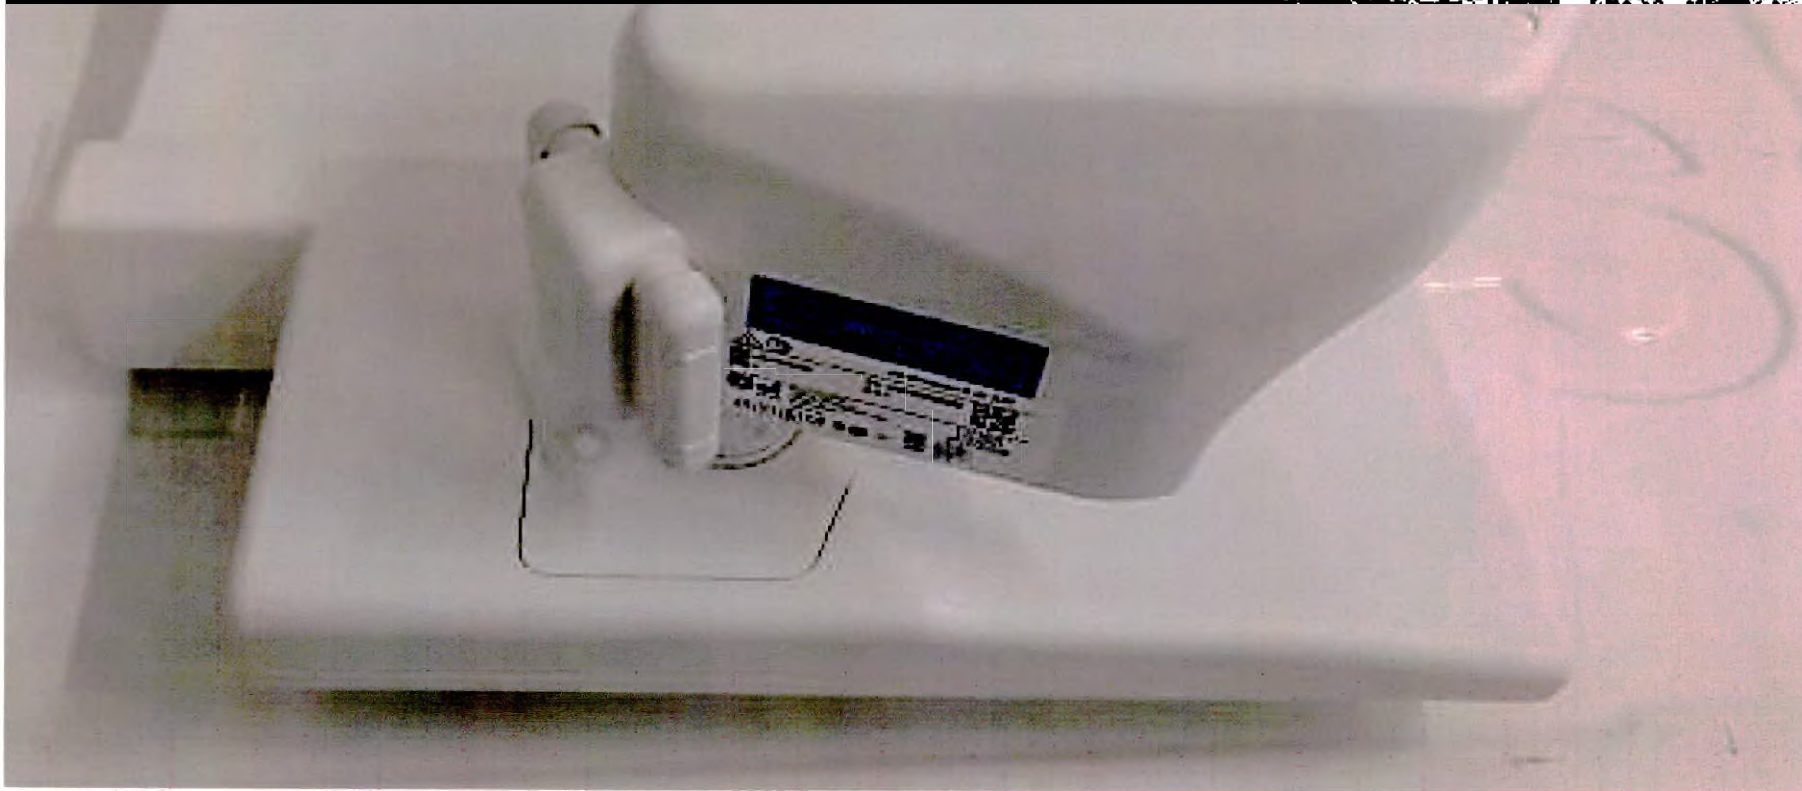

6.14. Катушка dS Shoulder 8ch. Вид 2.



6.15. Катущка dS Shoulder 16ch.

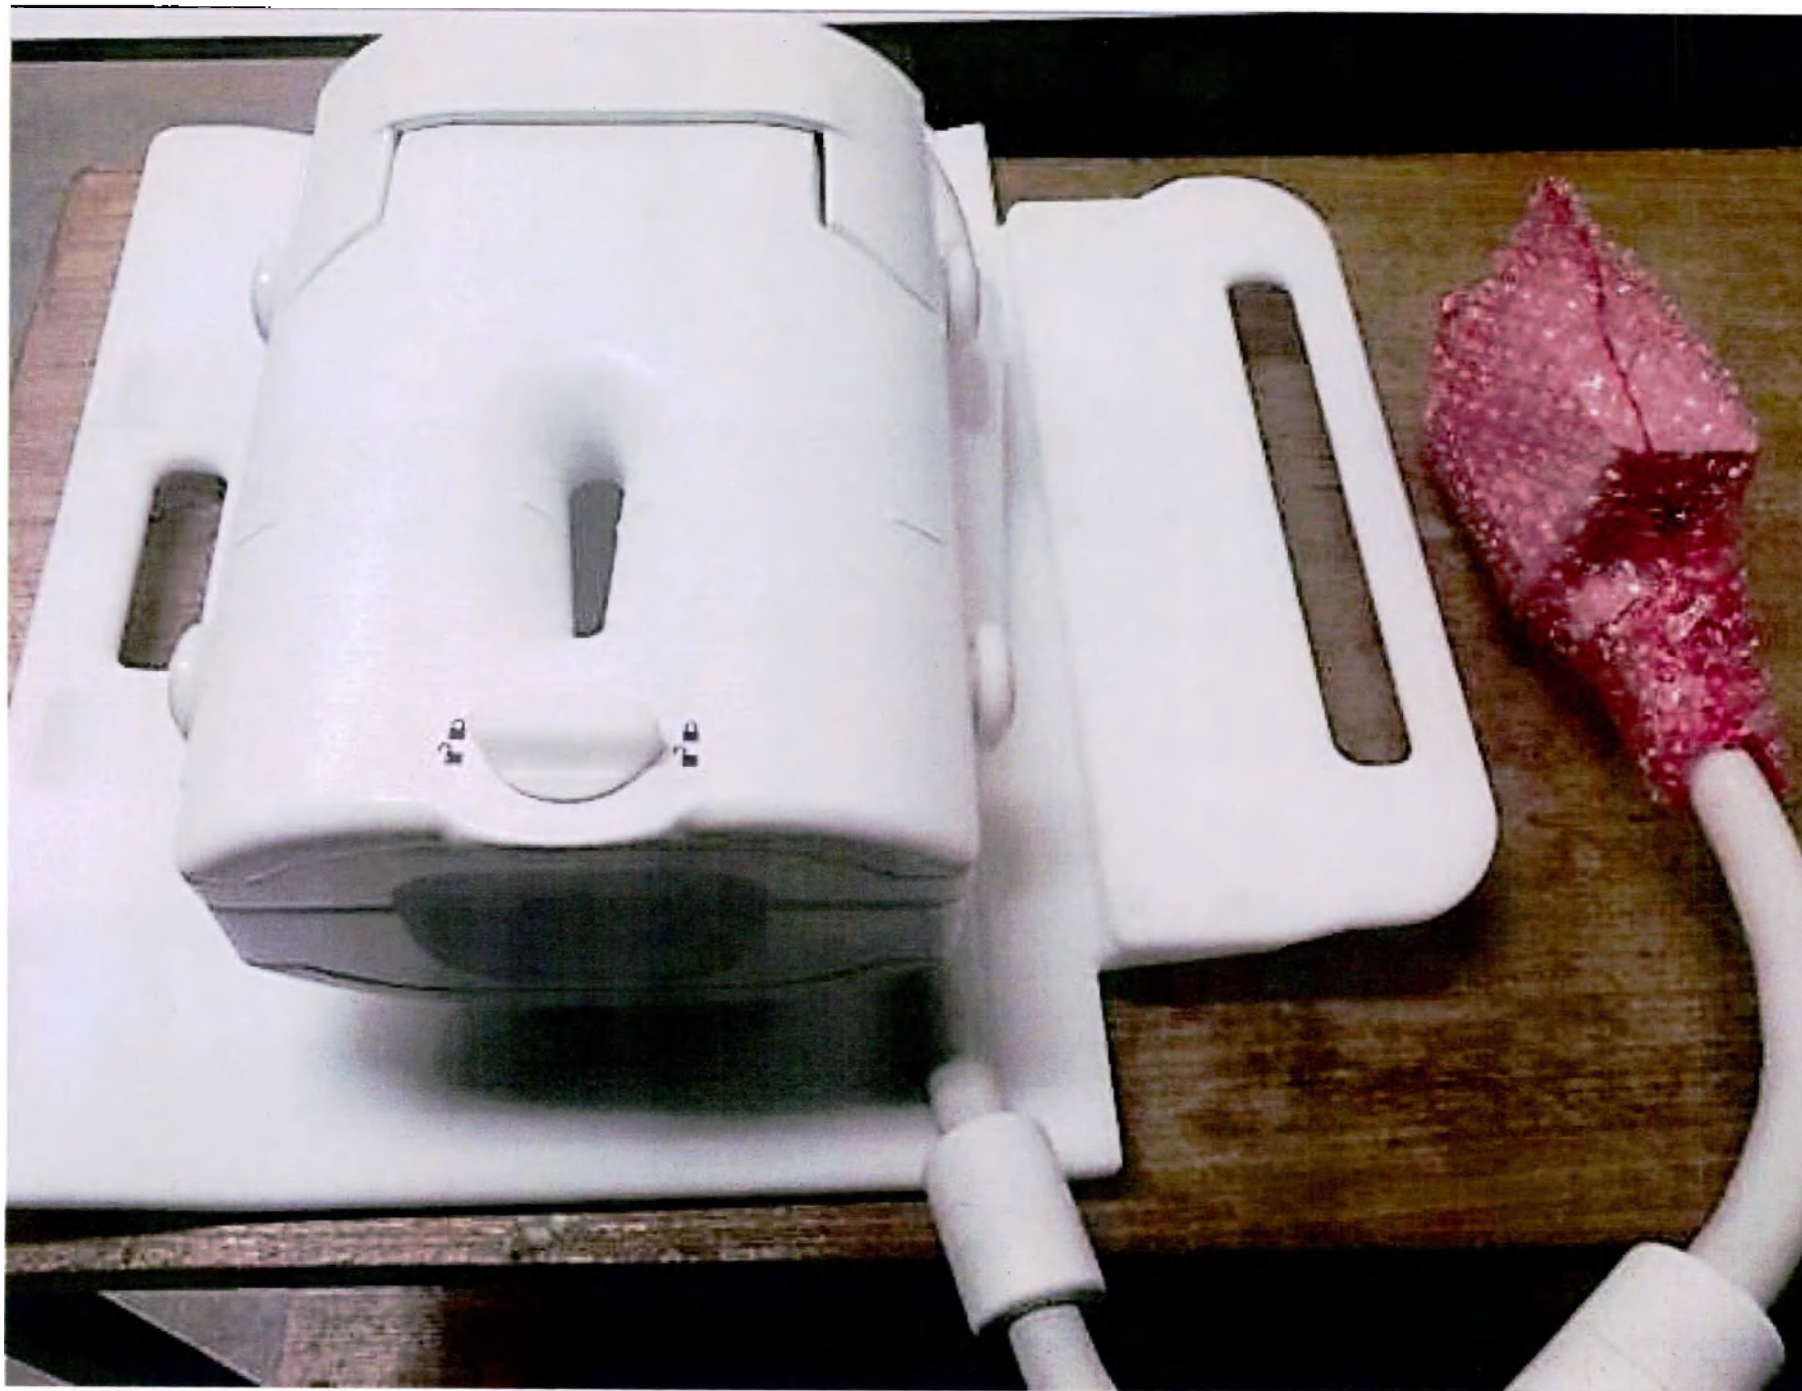

6.16. Катущка dS Wrist 8ch.



6.17. Катушка dS HandWrist 16ch.



6.18. 16-канальная катушка dS Кнее.





6.19. 16-канальная катушка dS T/R Knee.





6.20. 8-канальная катушка dS Knee.



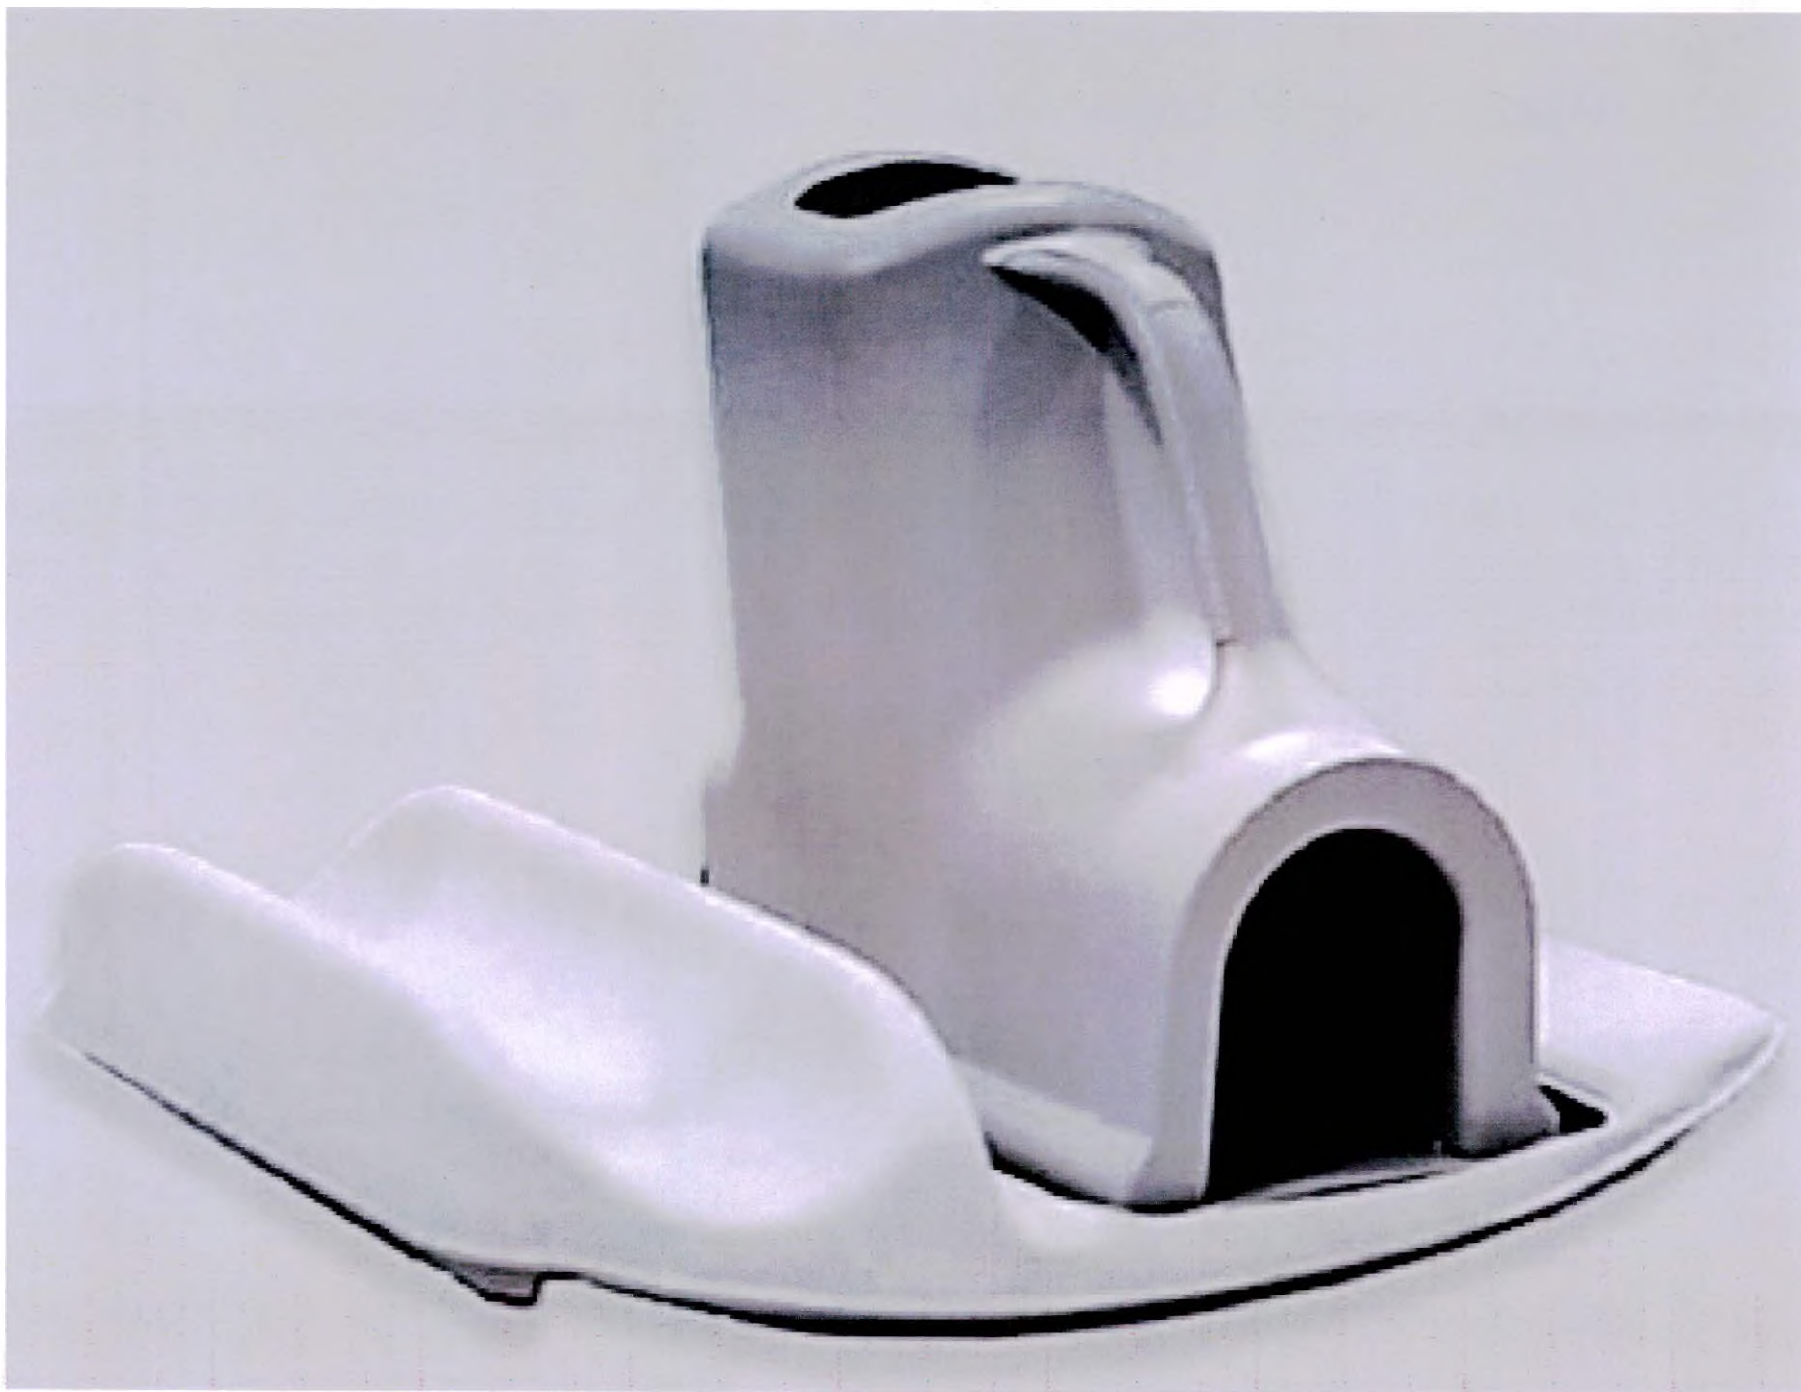


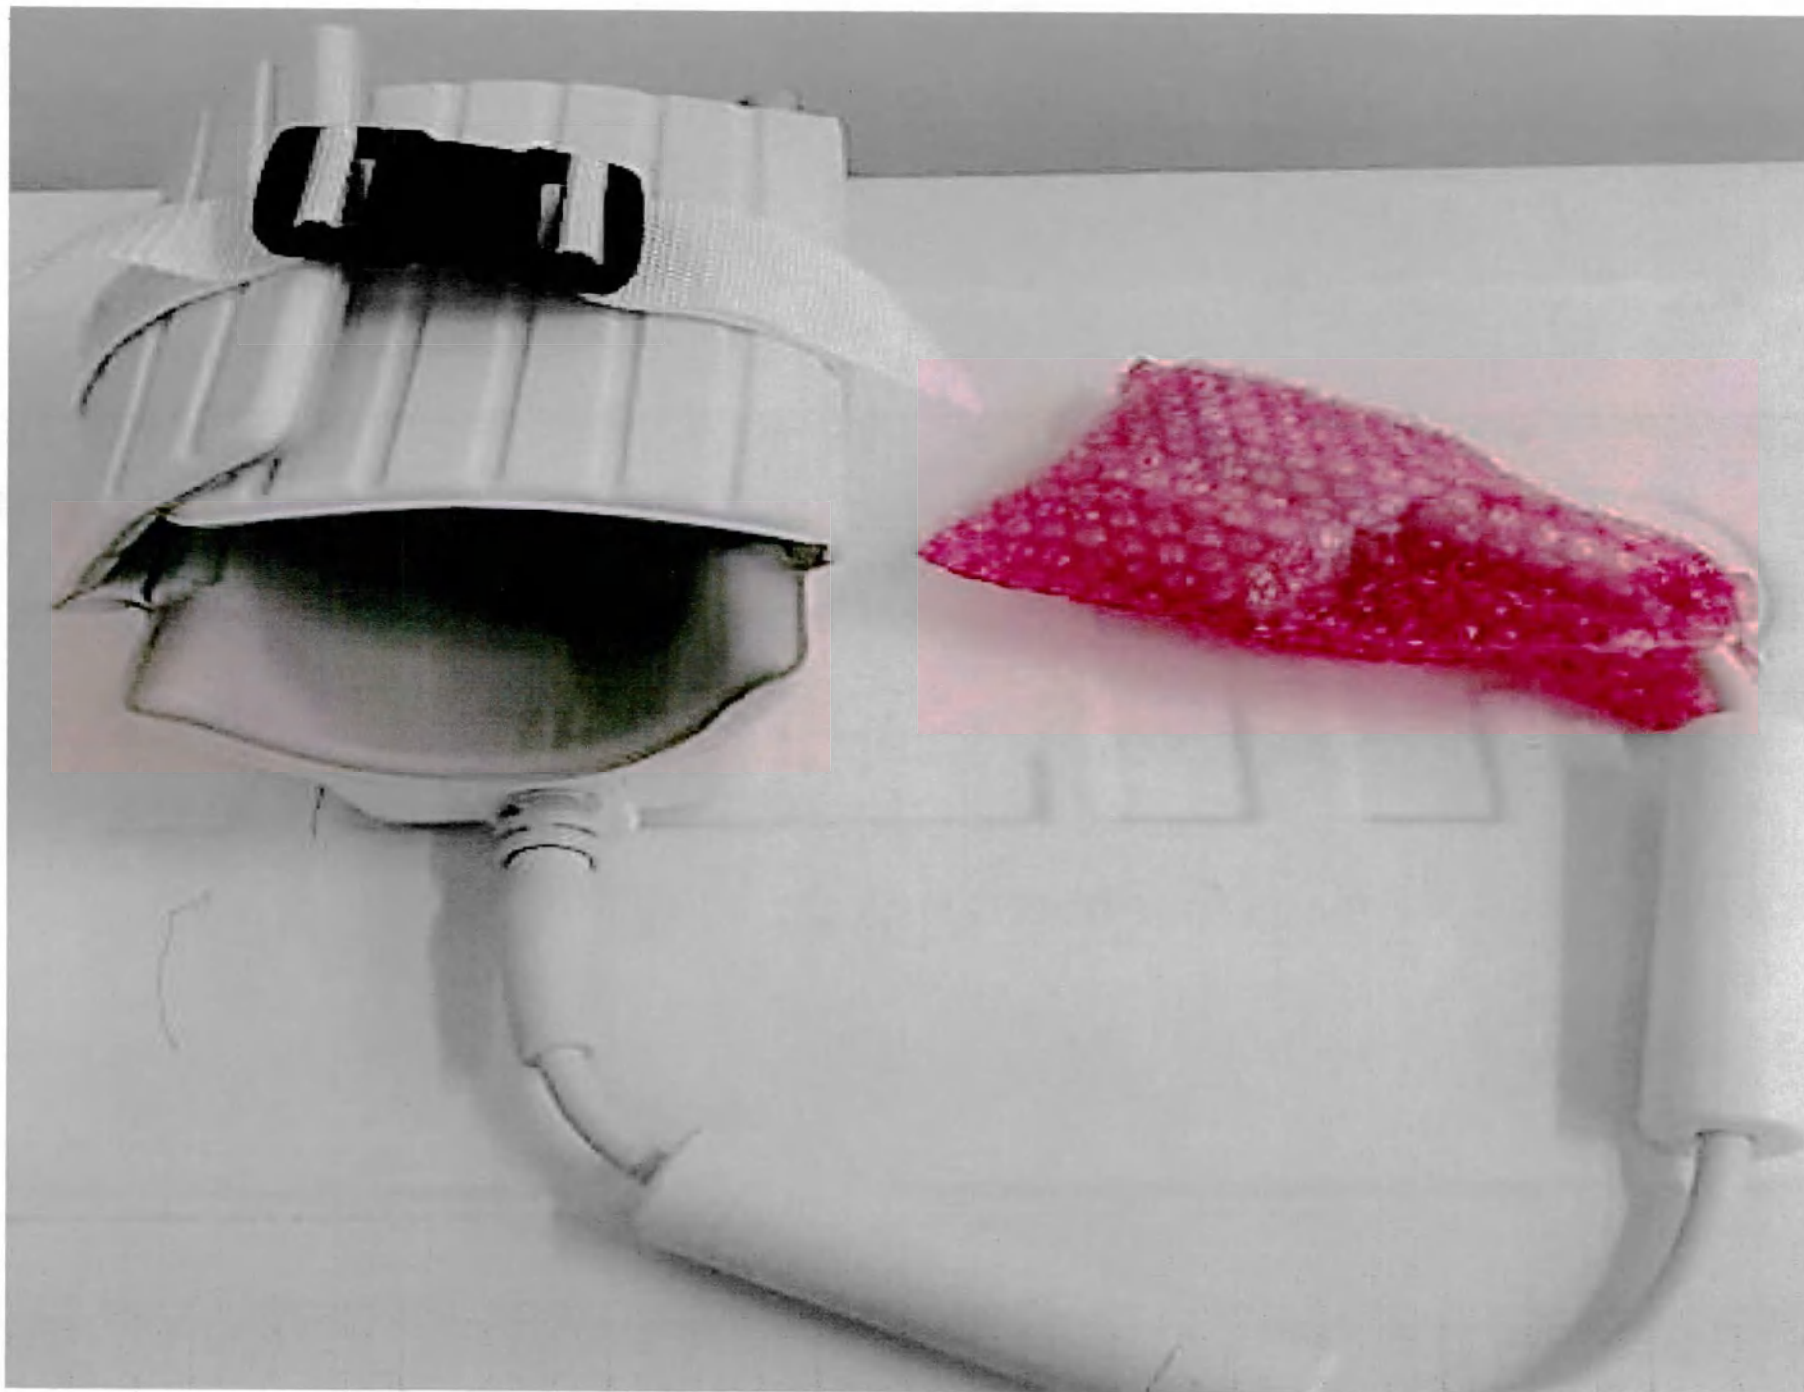

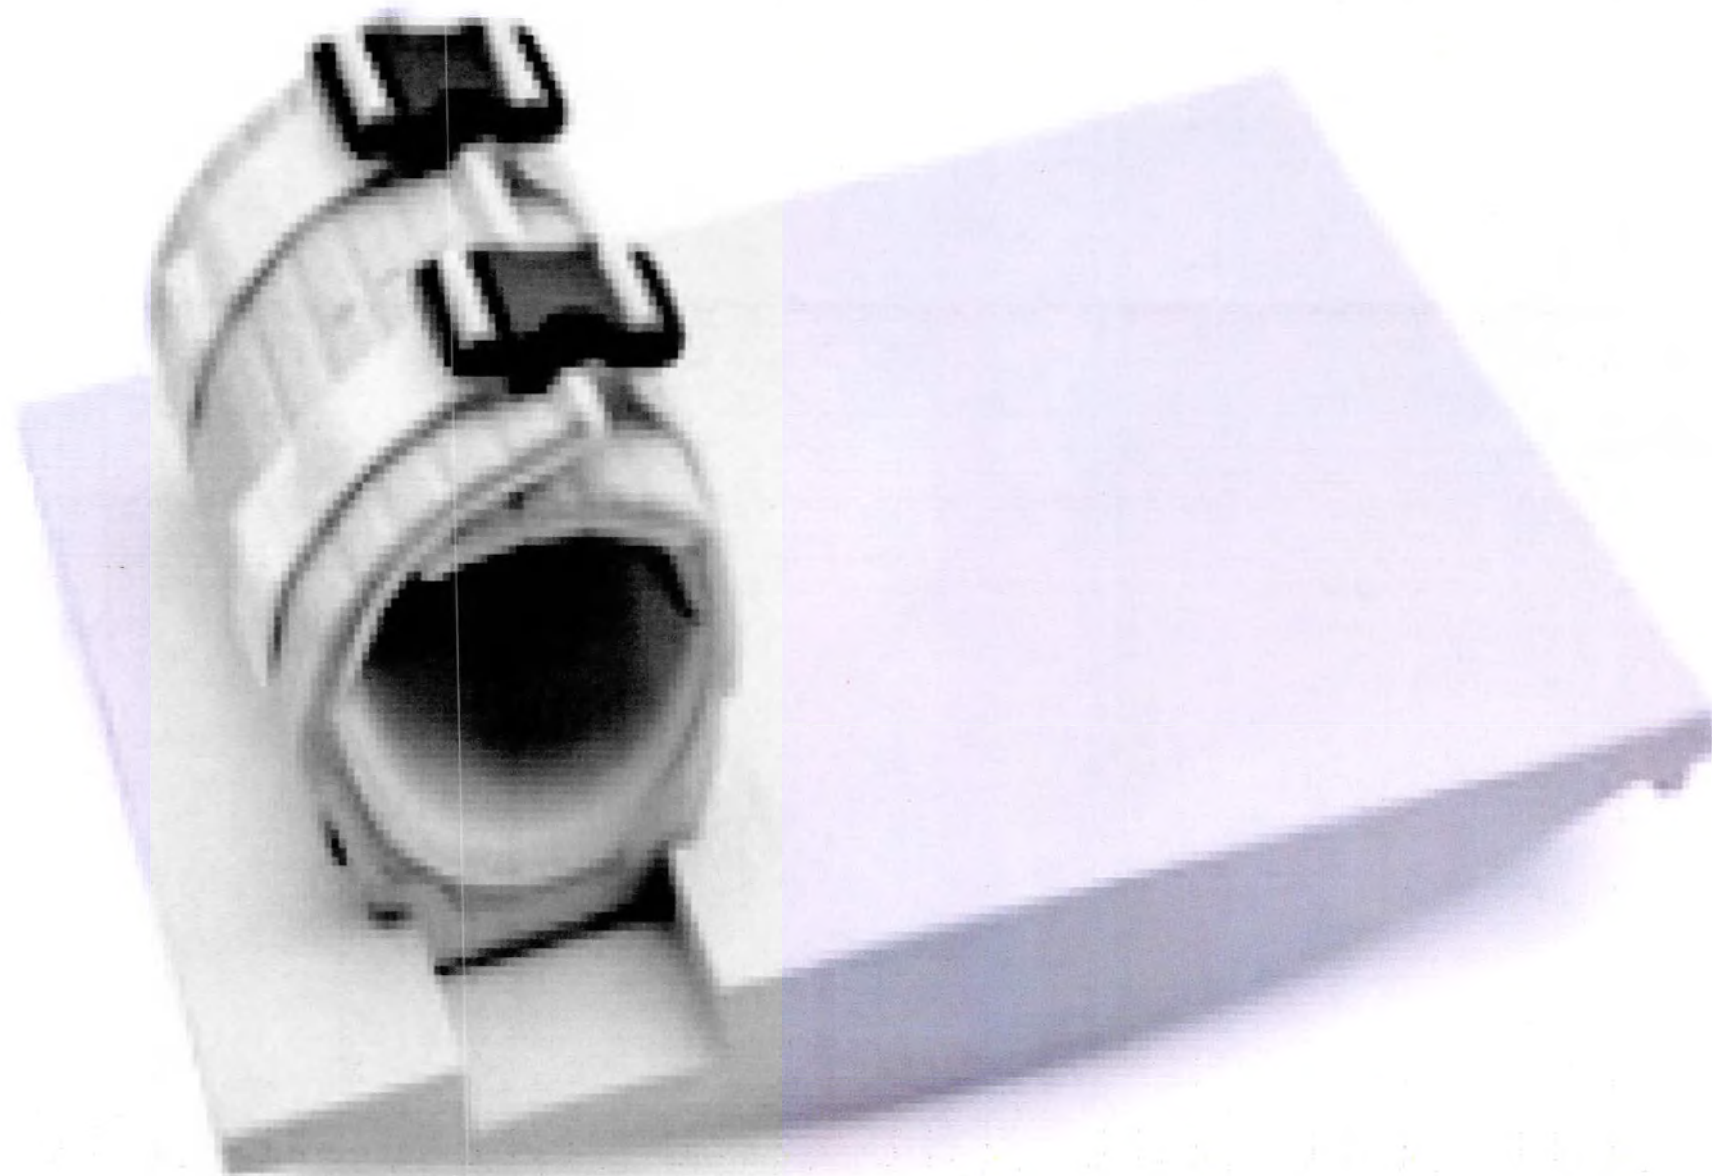


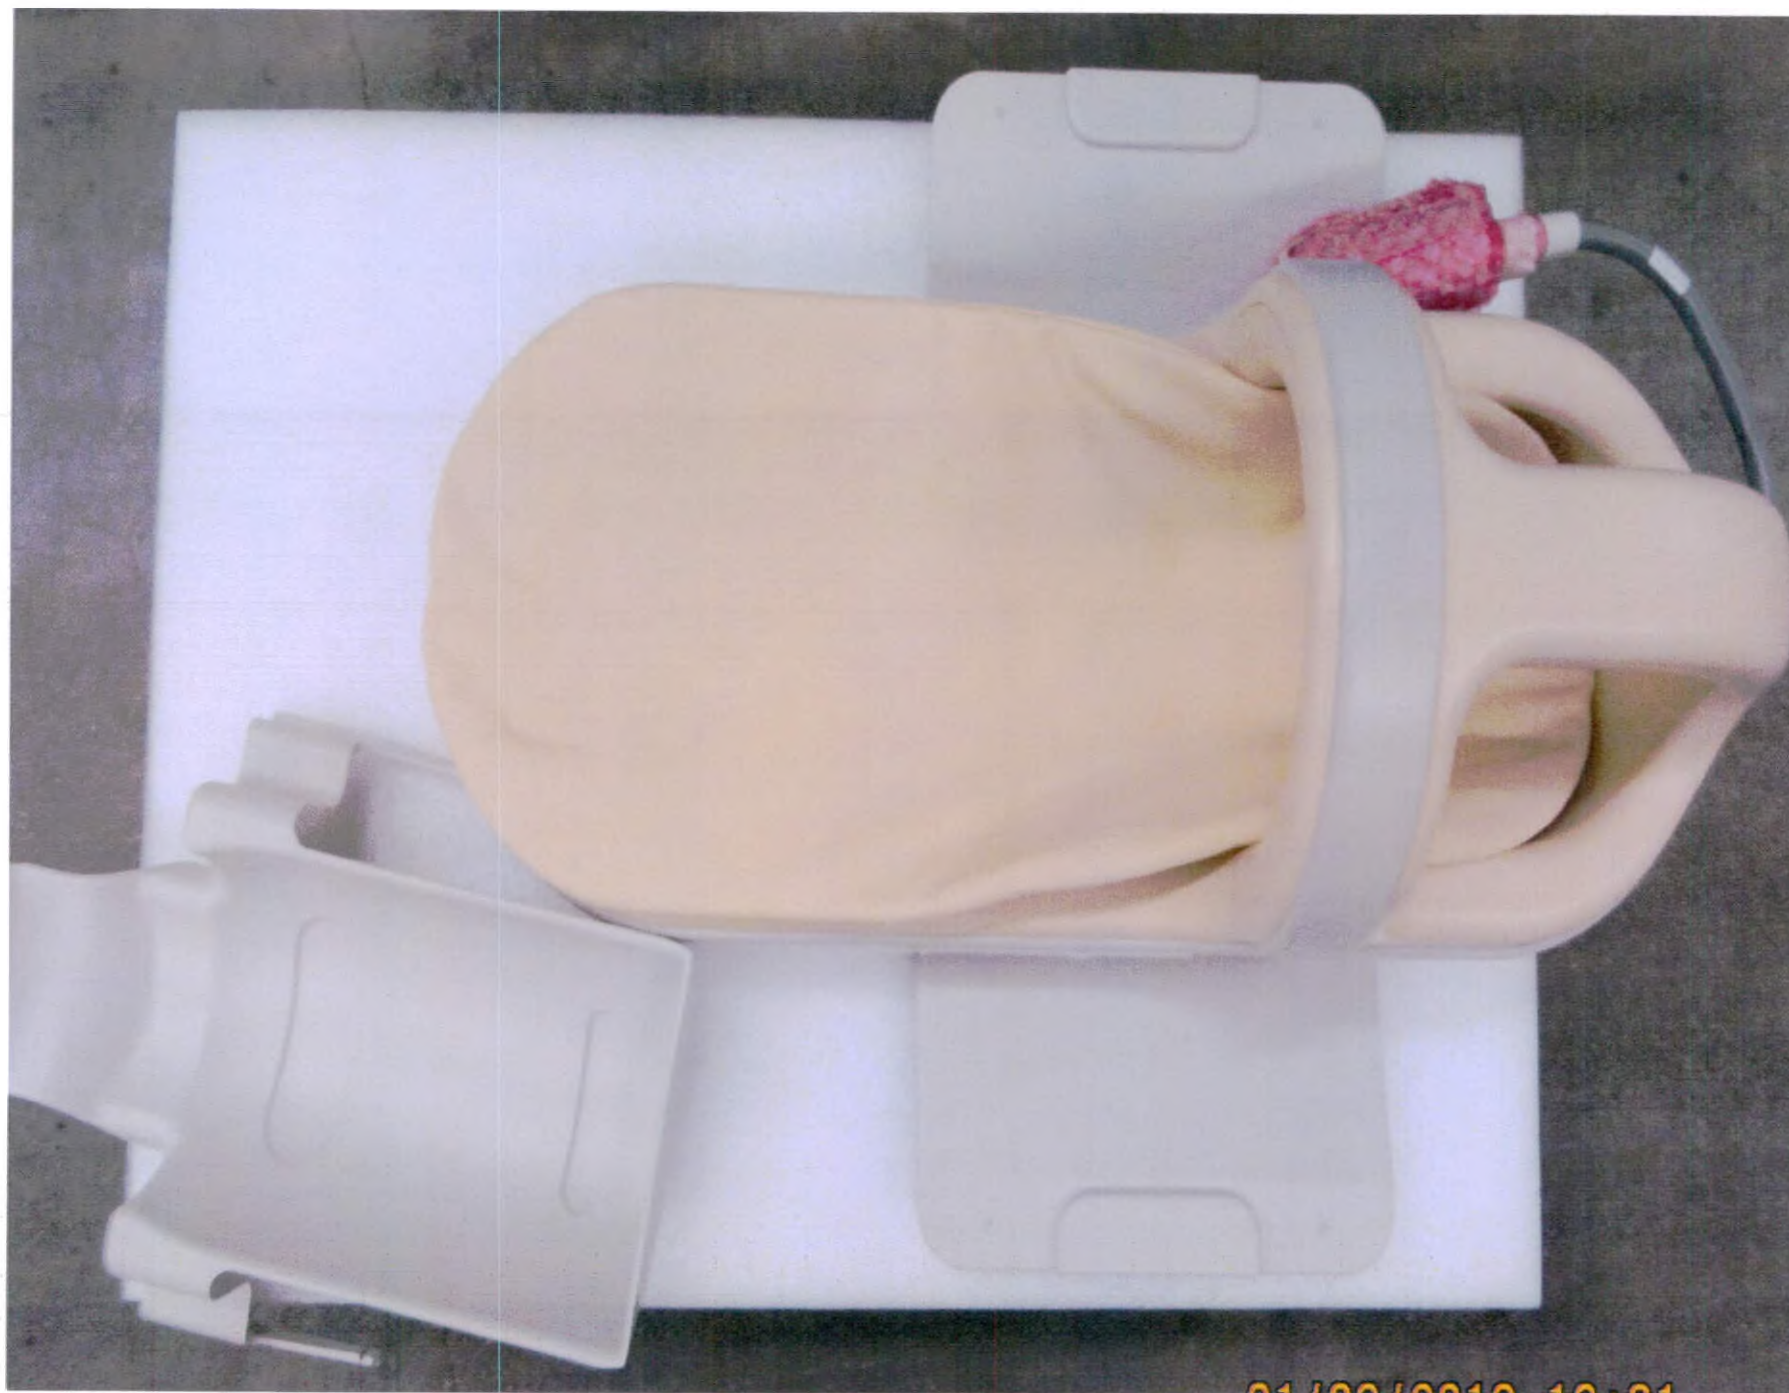



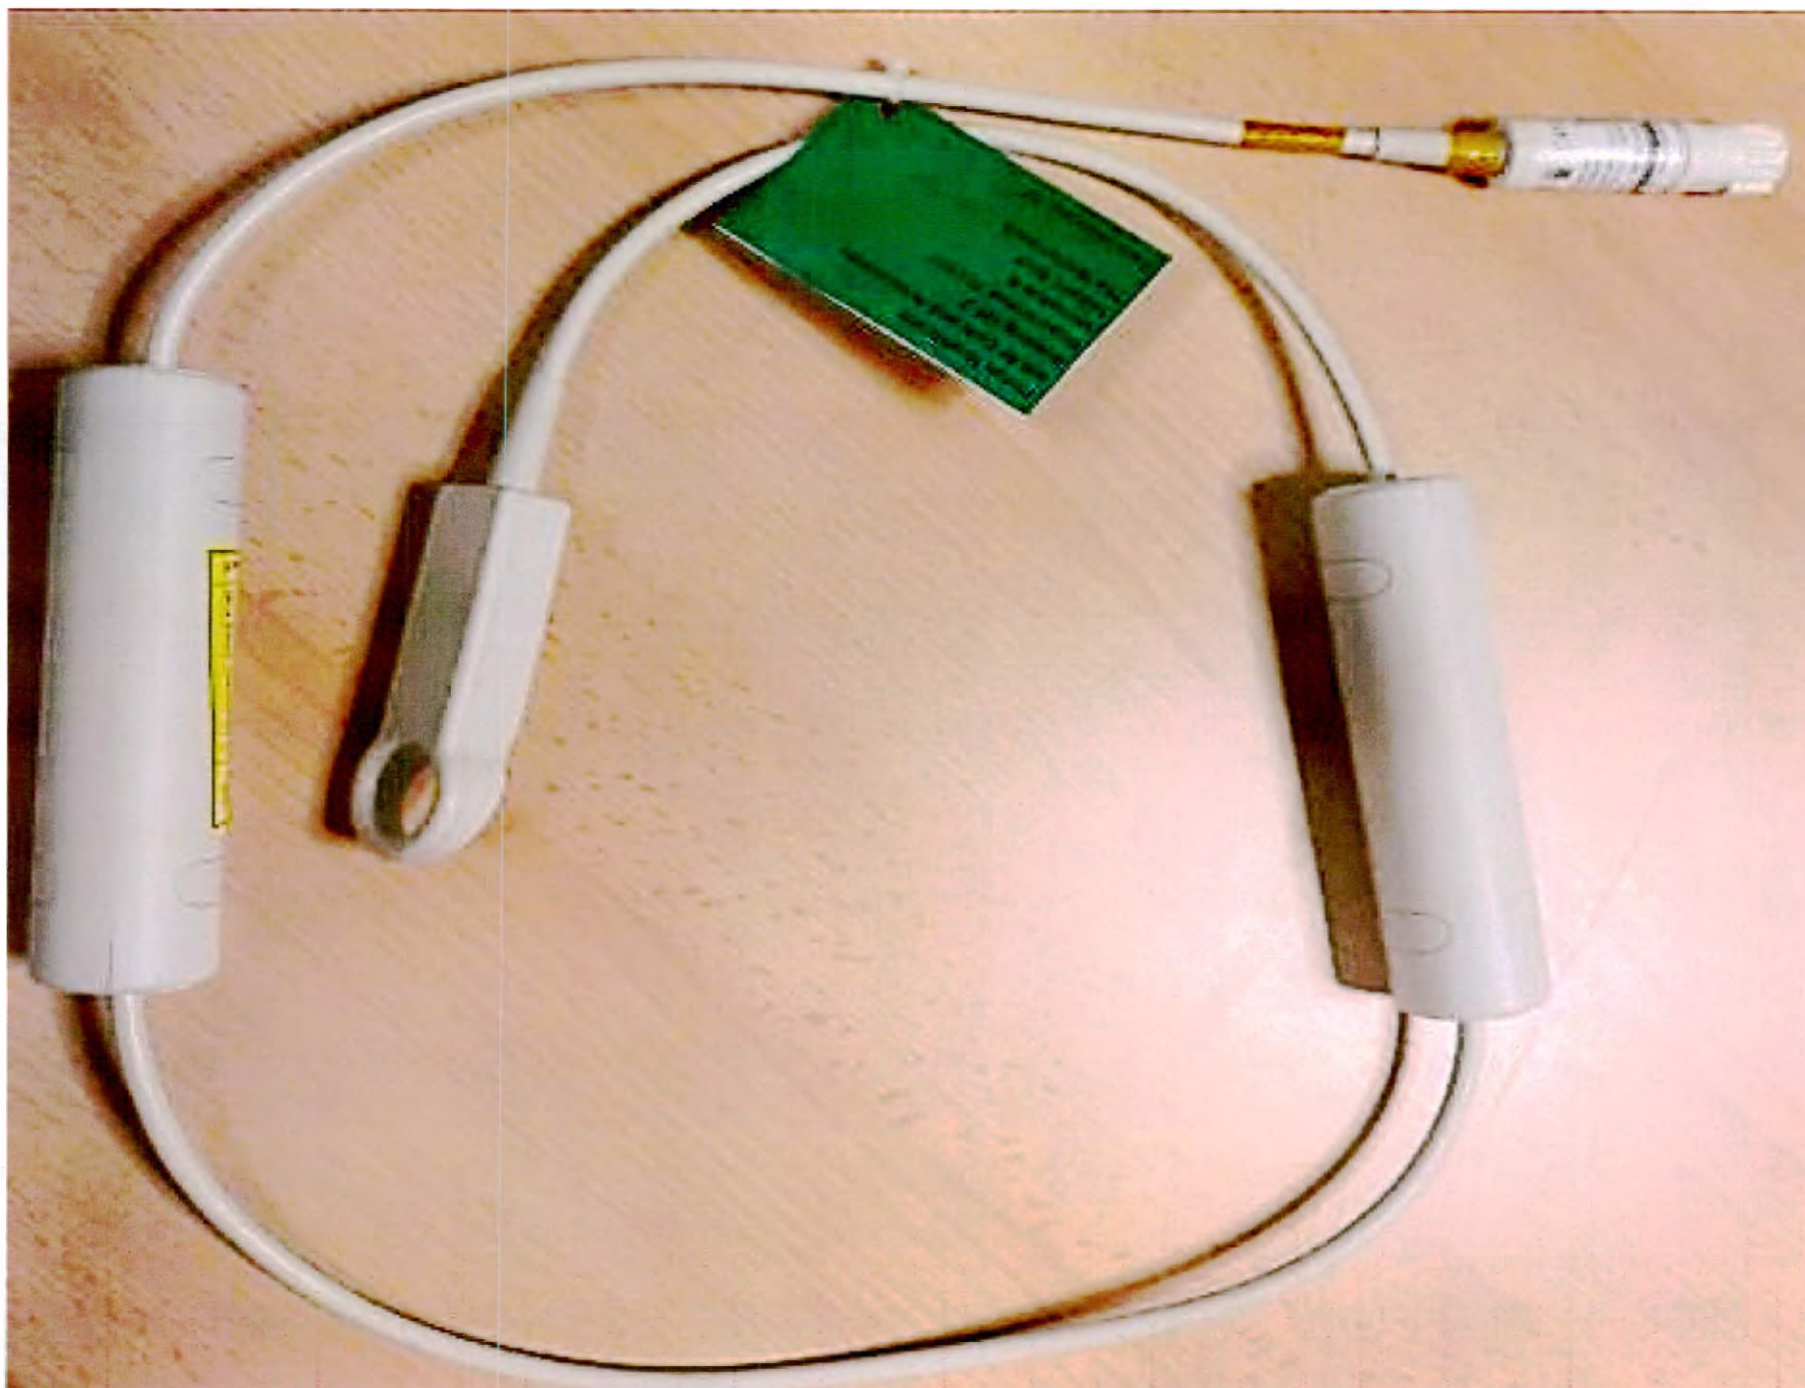

6.27. Катюшка dS Microscopy. Вид 1.

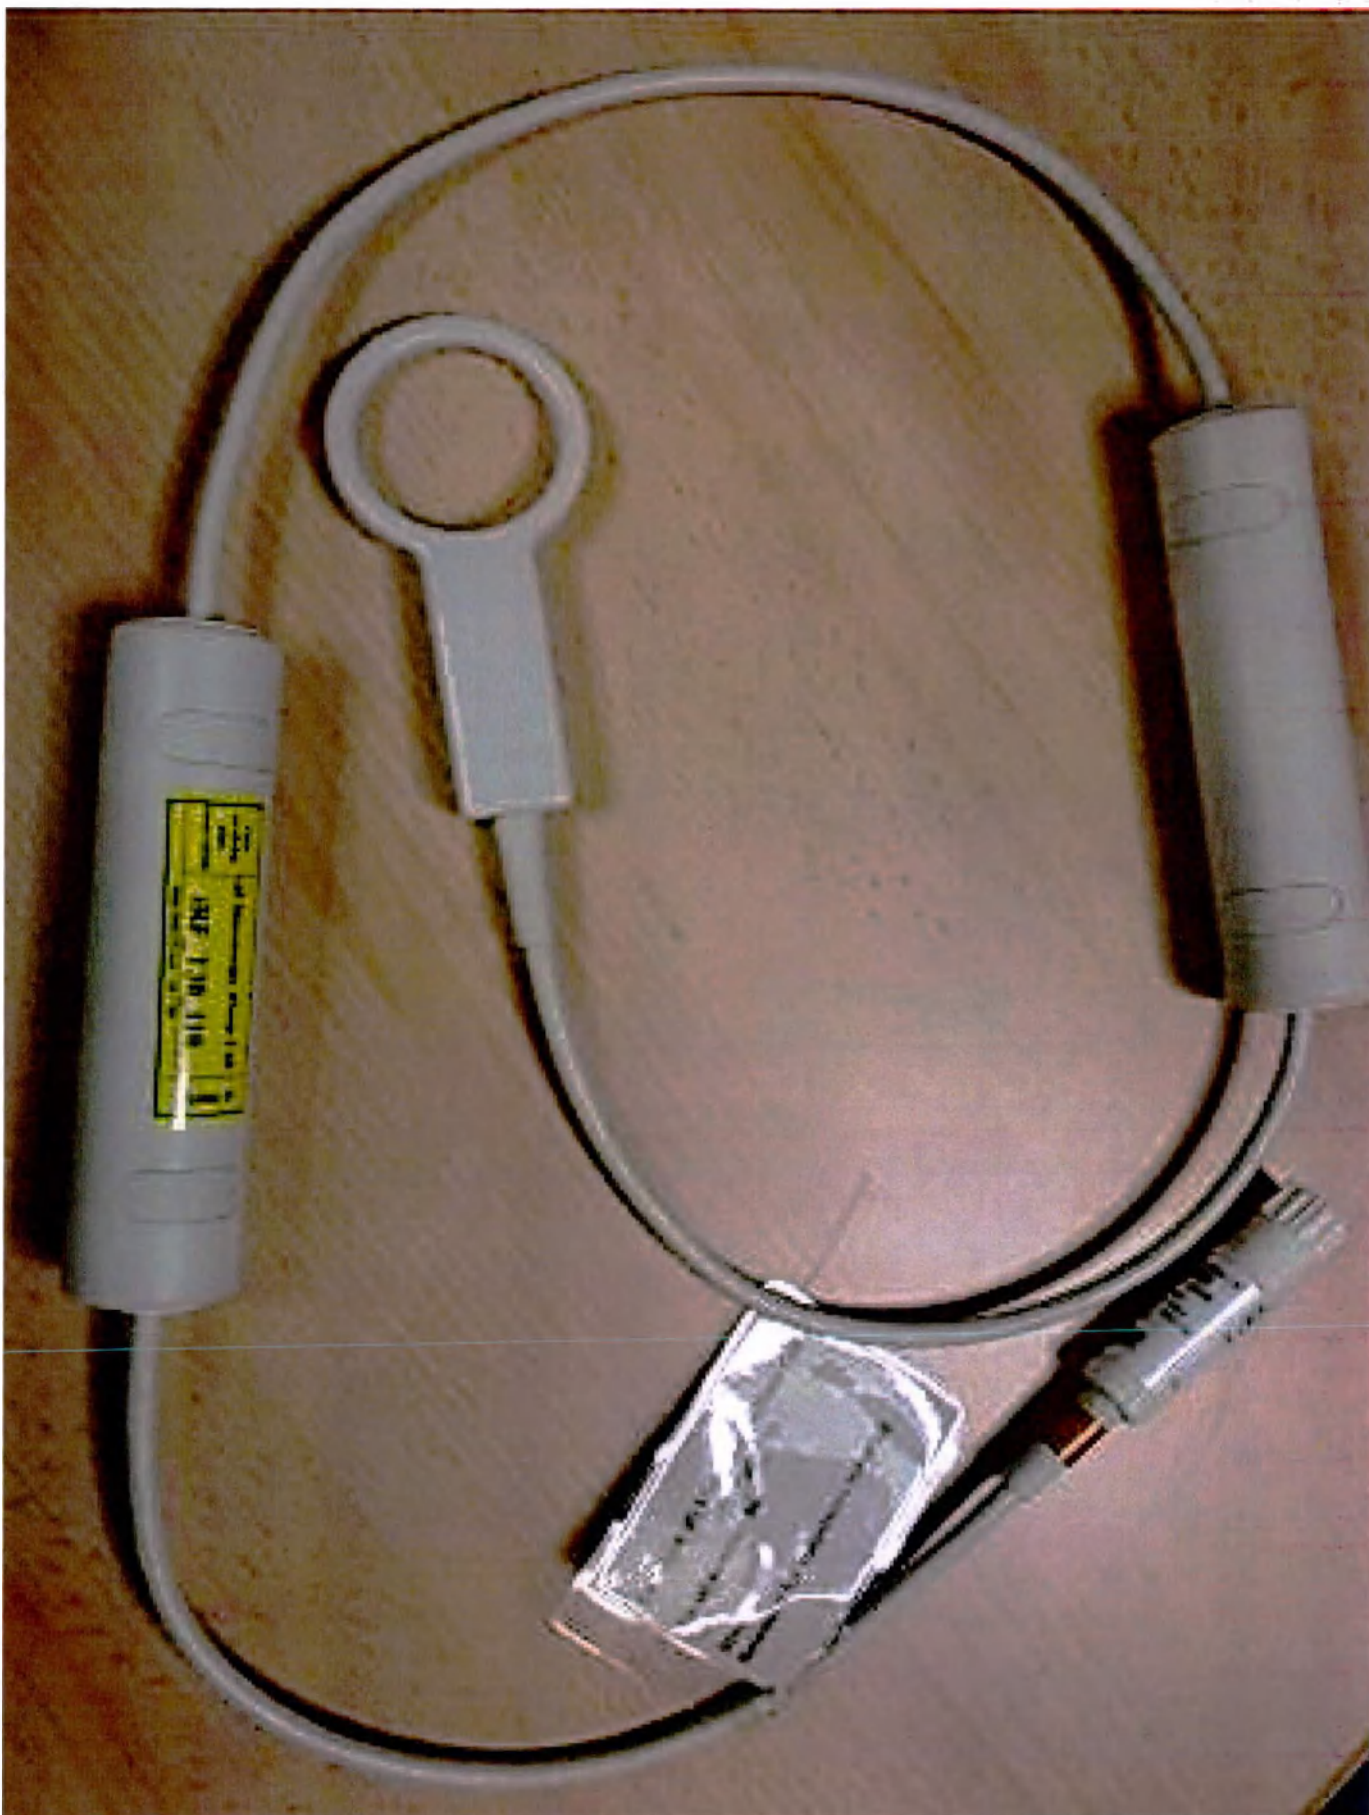

6.27. Катужка dS Microscopy. Вид 2.












7. Интерфейс dStream Interface.

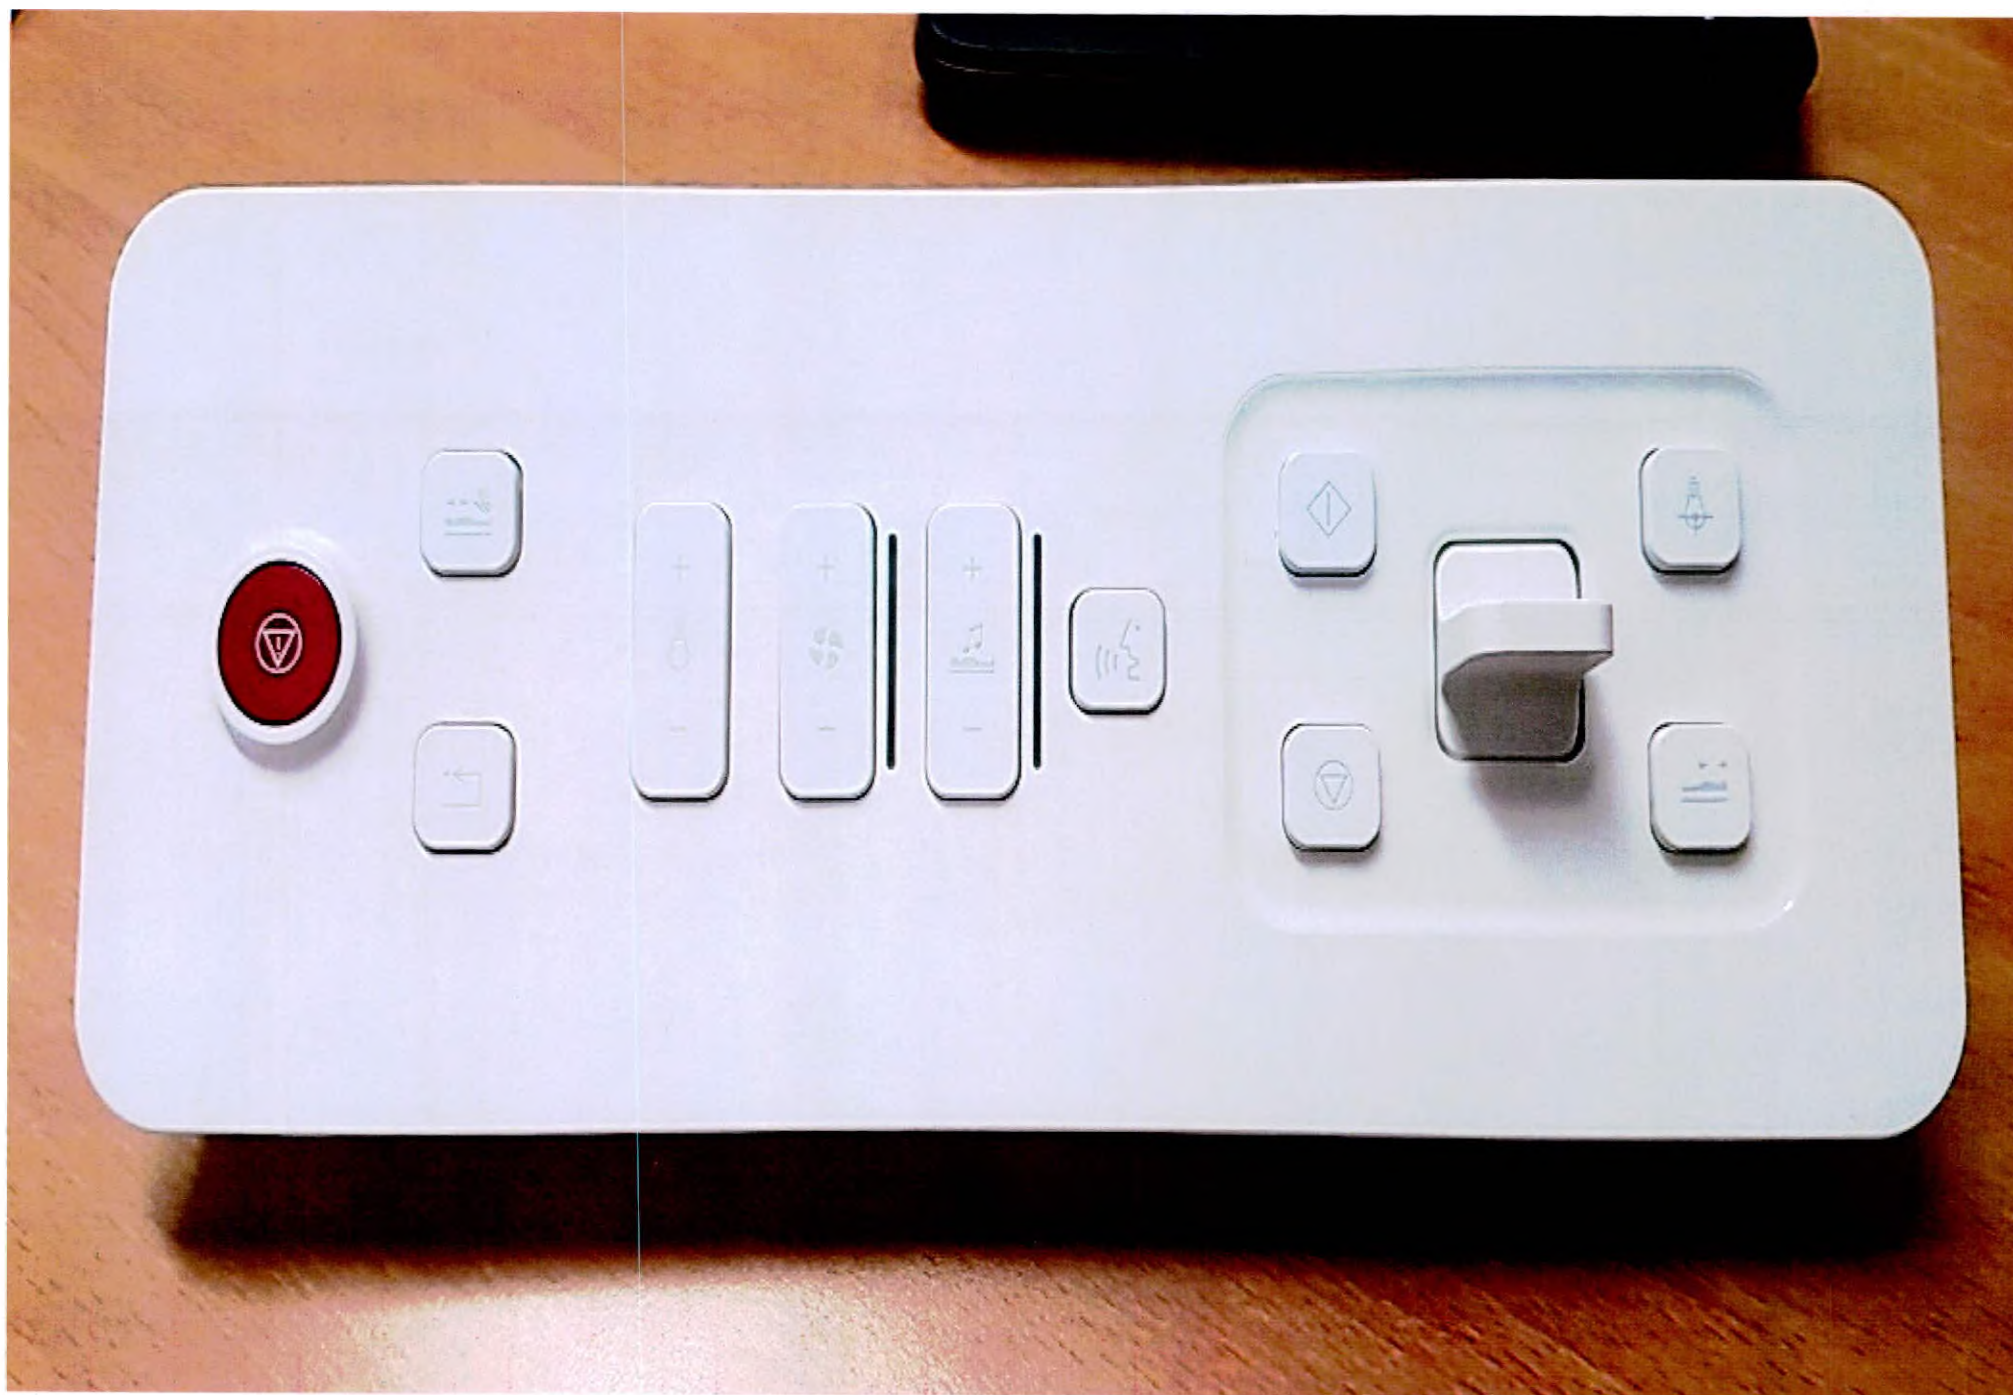



PHILIPS






10. Лазерное устройство светового визирования. Вид 2.




11. Пульт оператора.

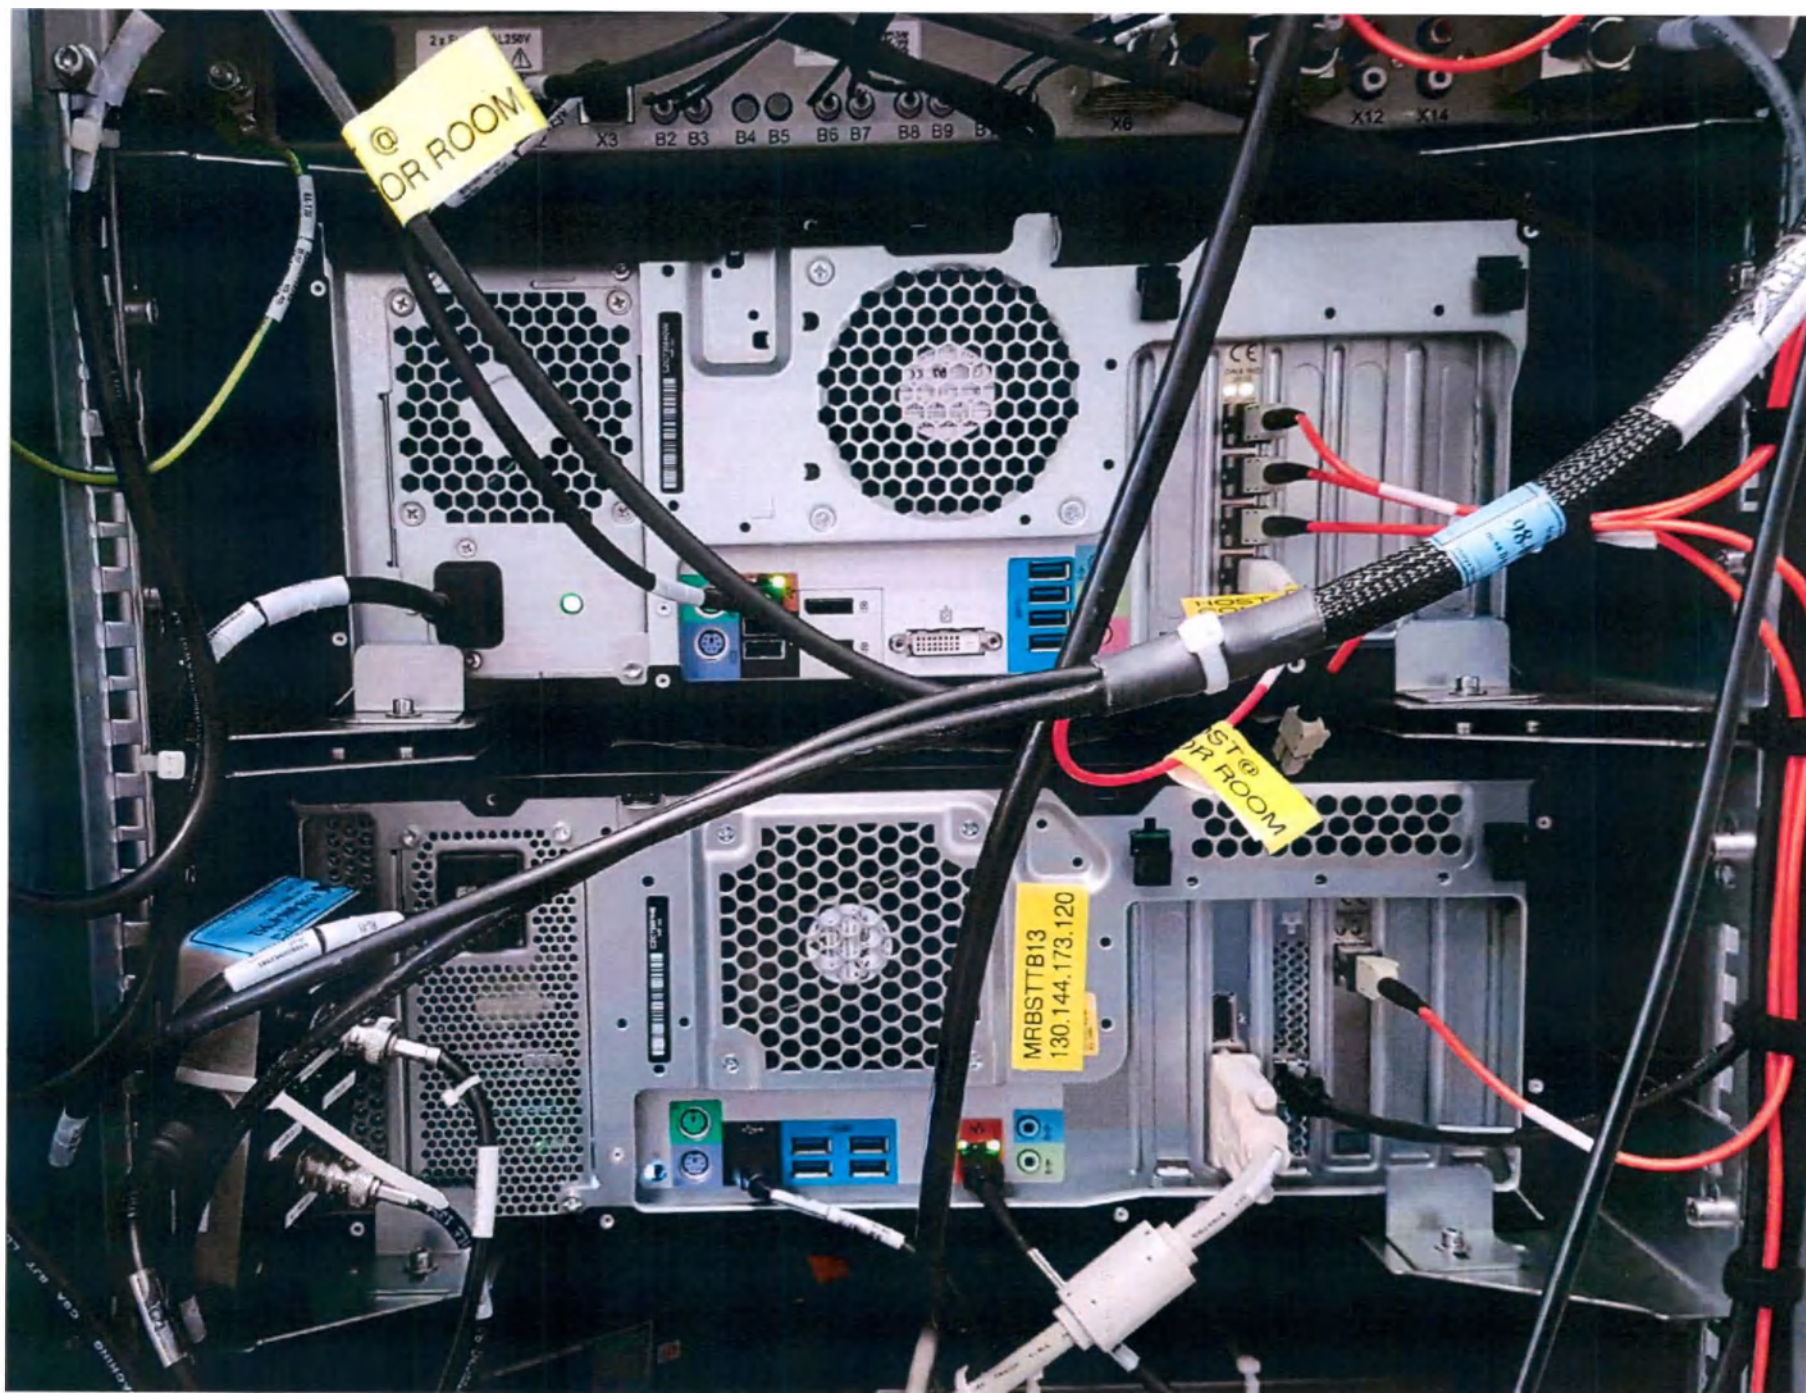

12. Компьютерная система (системный блок с оперативной системой Windows и ПО МР-системы версии R 11.1 и выше на электронных и/или виртуальных носителях). Системный блок



13. Программное обеспечение для программных приложений к системе МР томографа на оптических носителях.

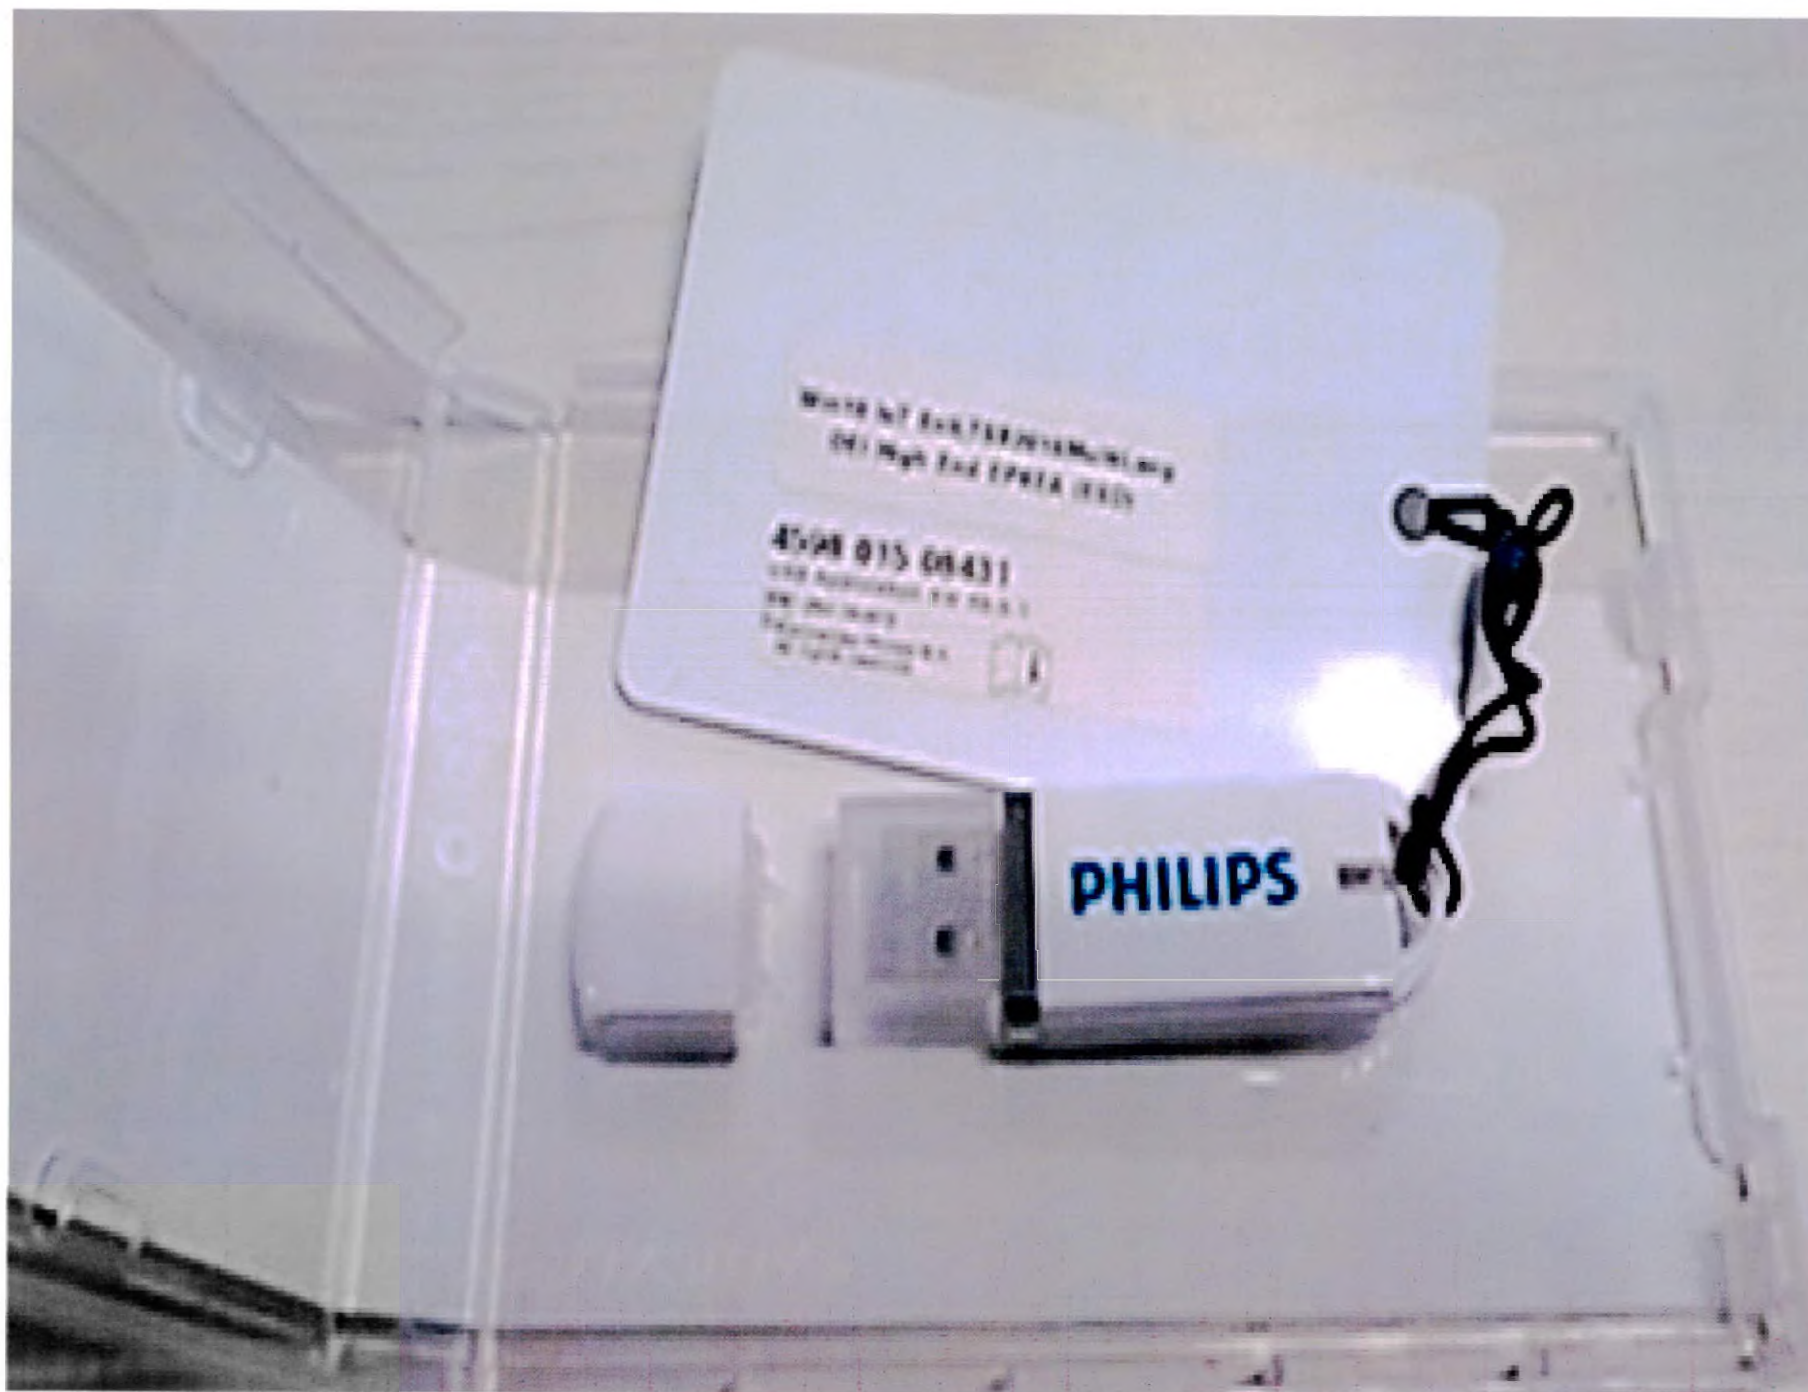



13. Программное обеспечение для программных приложений к системе МР томографа на электронных носителях.





14.1. Широкоэкранный дисплей с USB-разъемами.

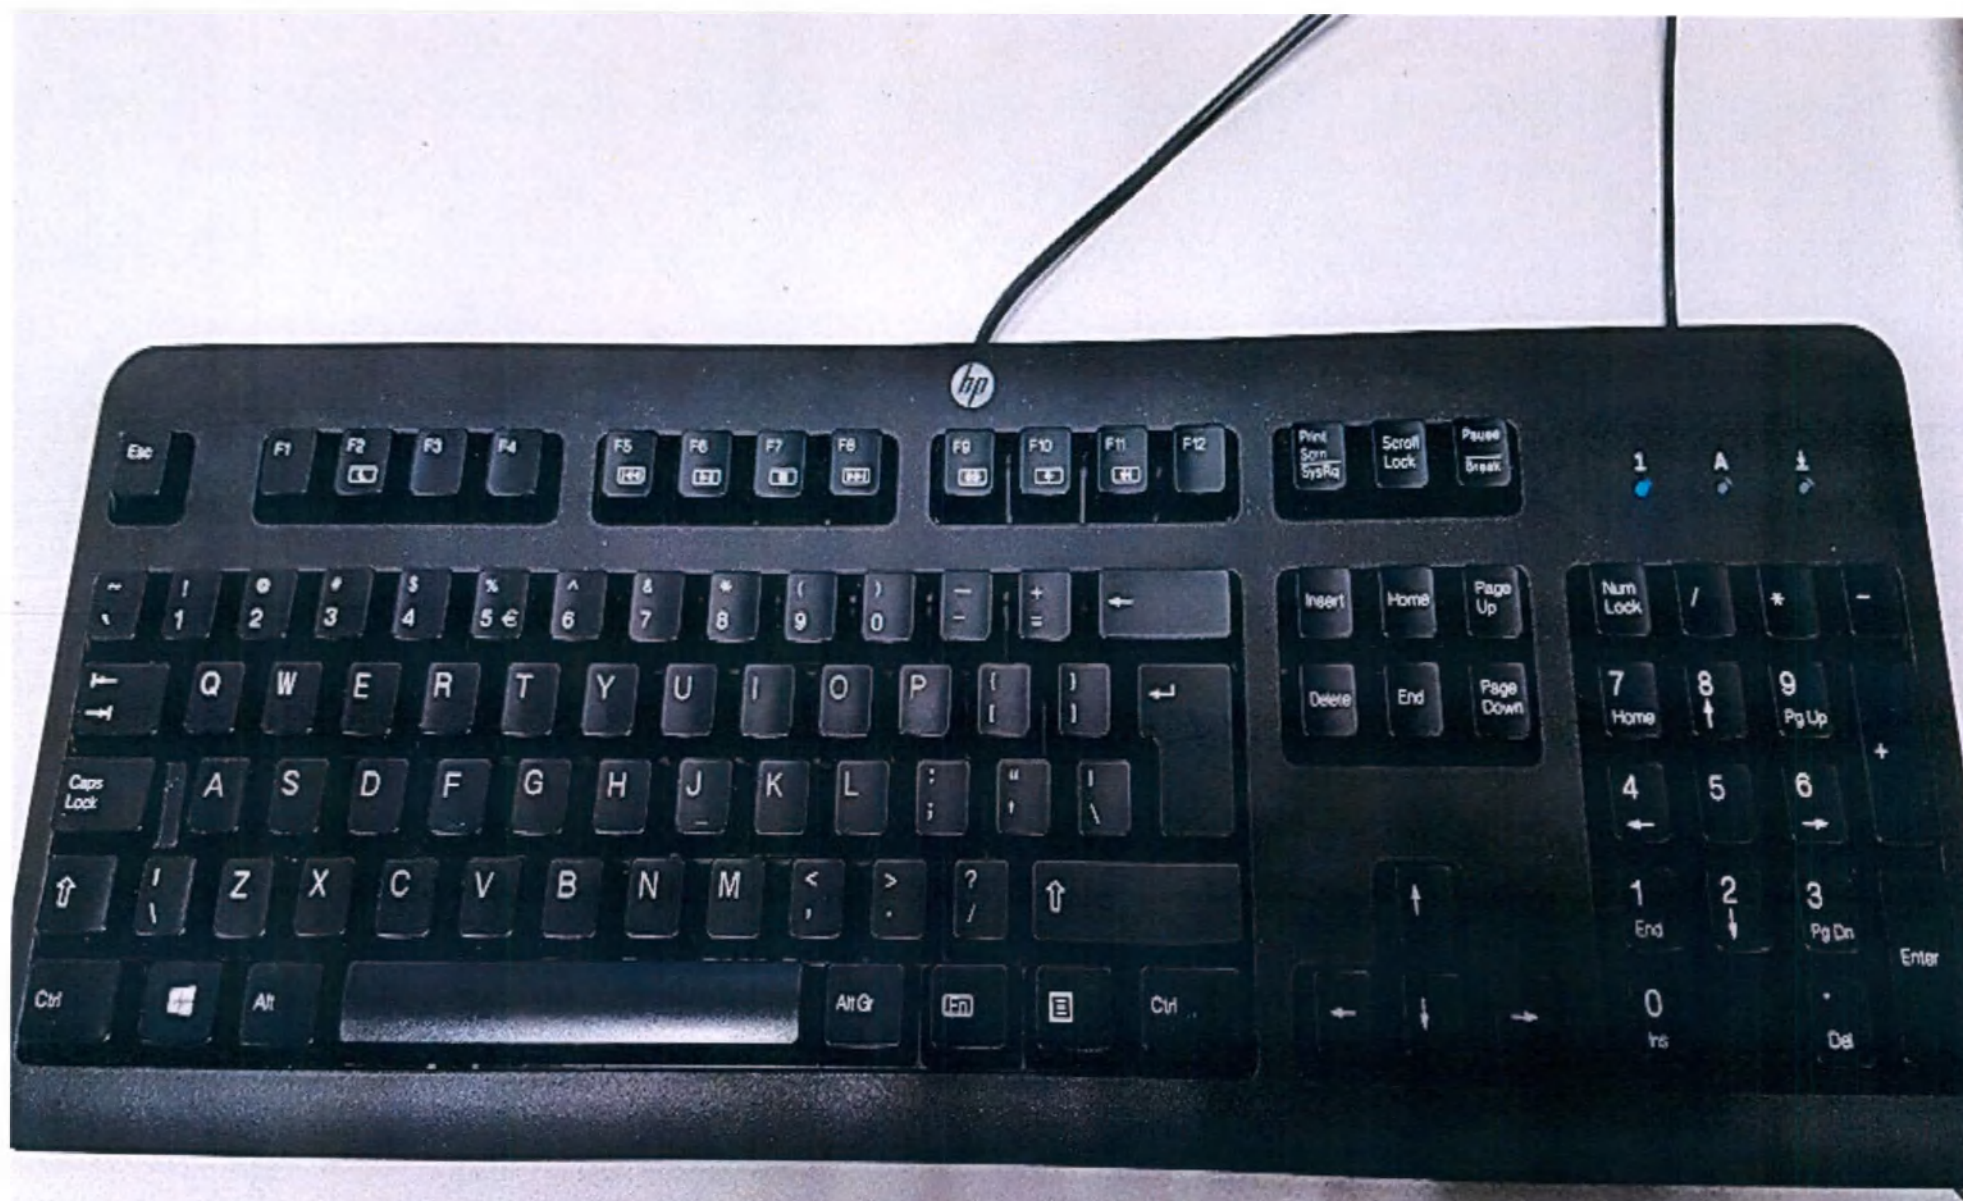

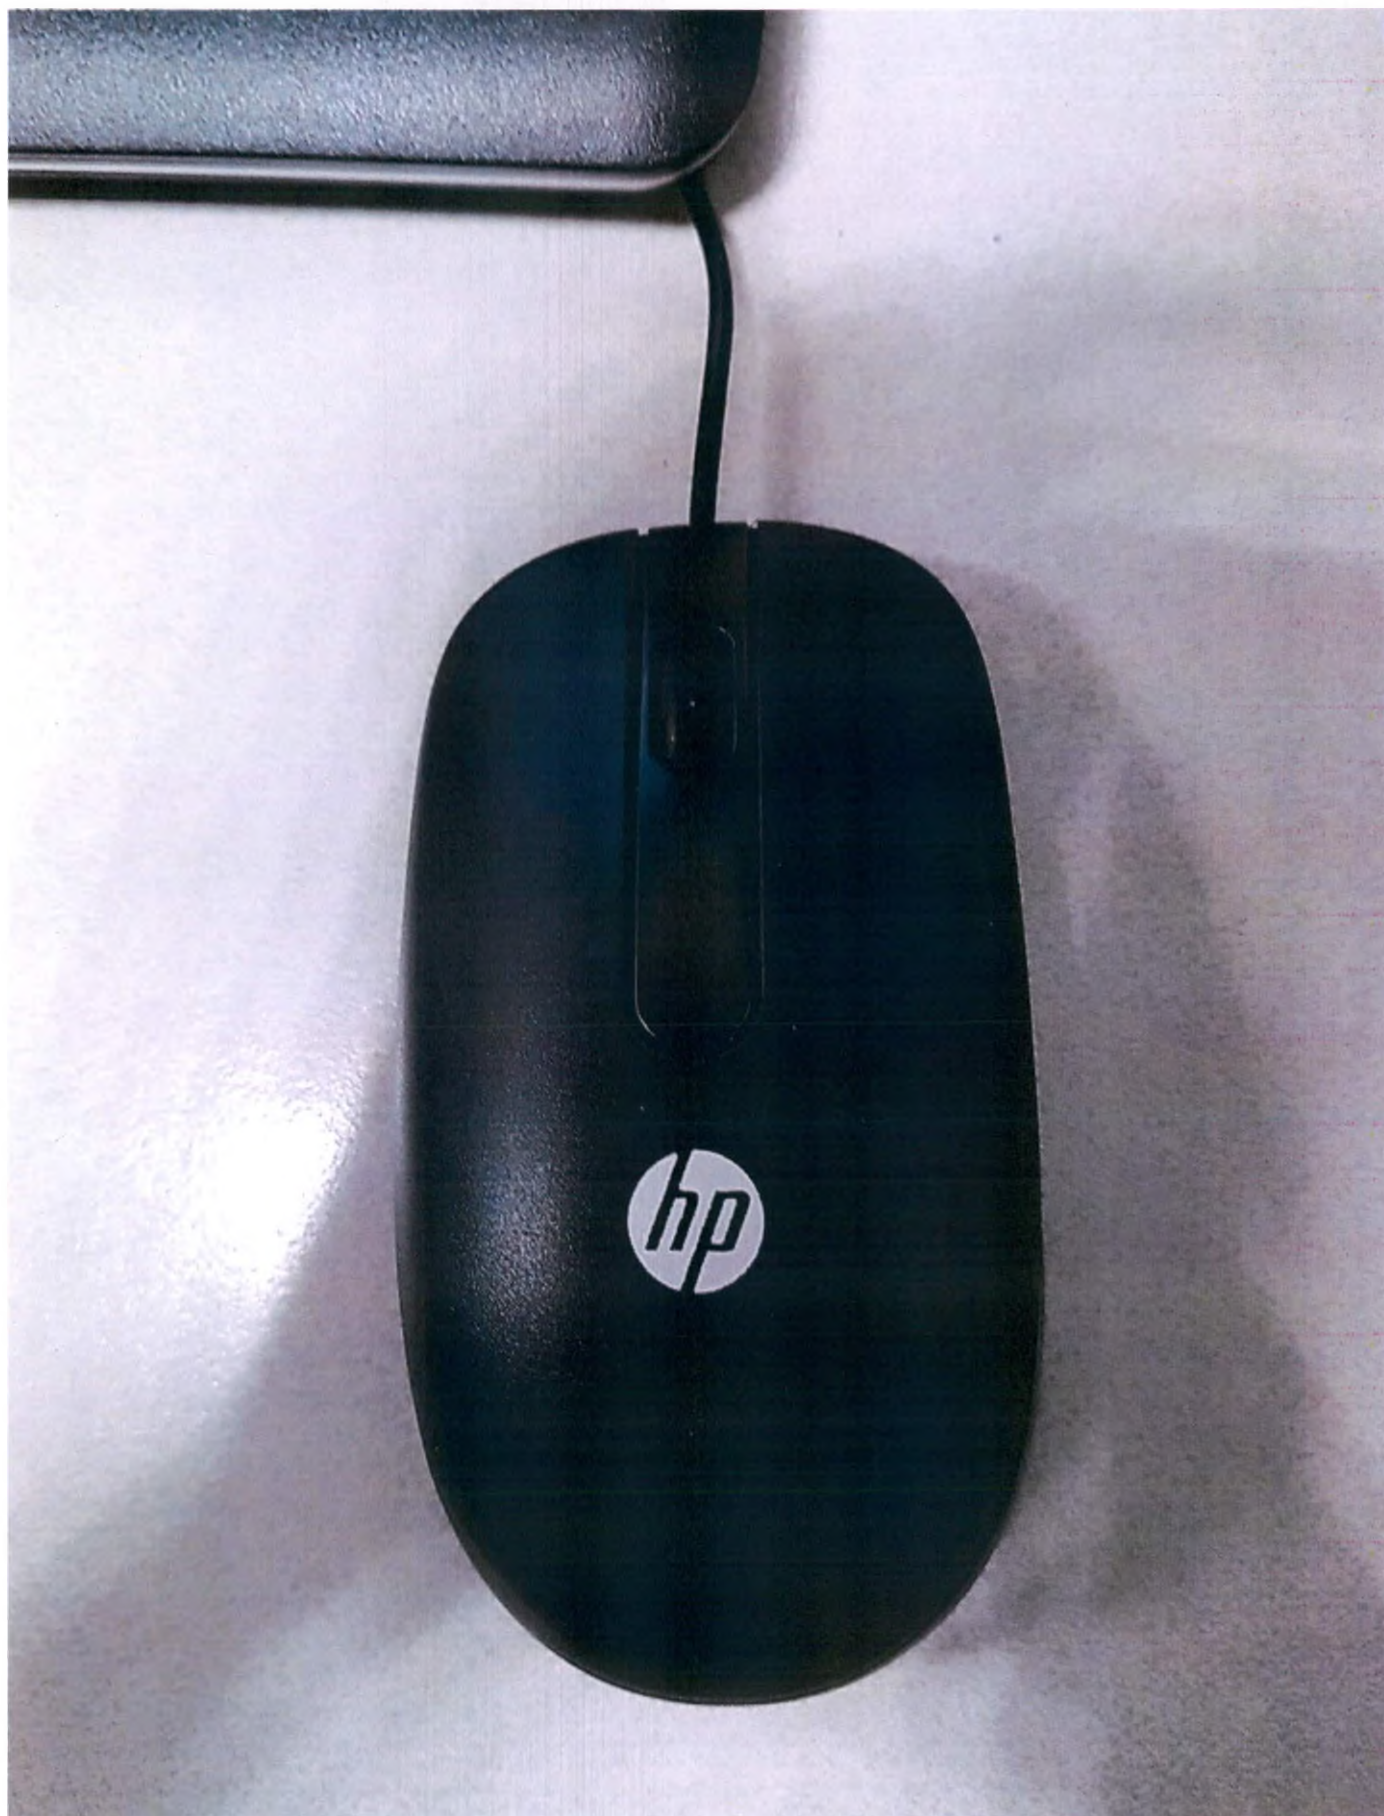



14.3. Мышь.




14.4. Система связи «оператор-пациент».

15. Средства позиционирования пациента.

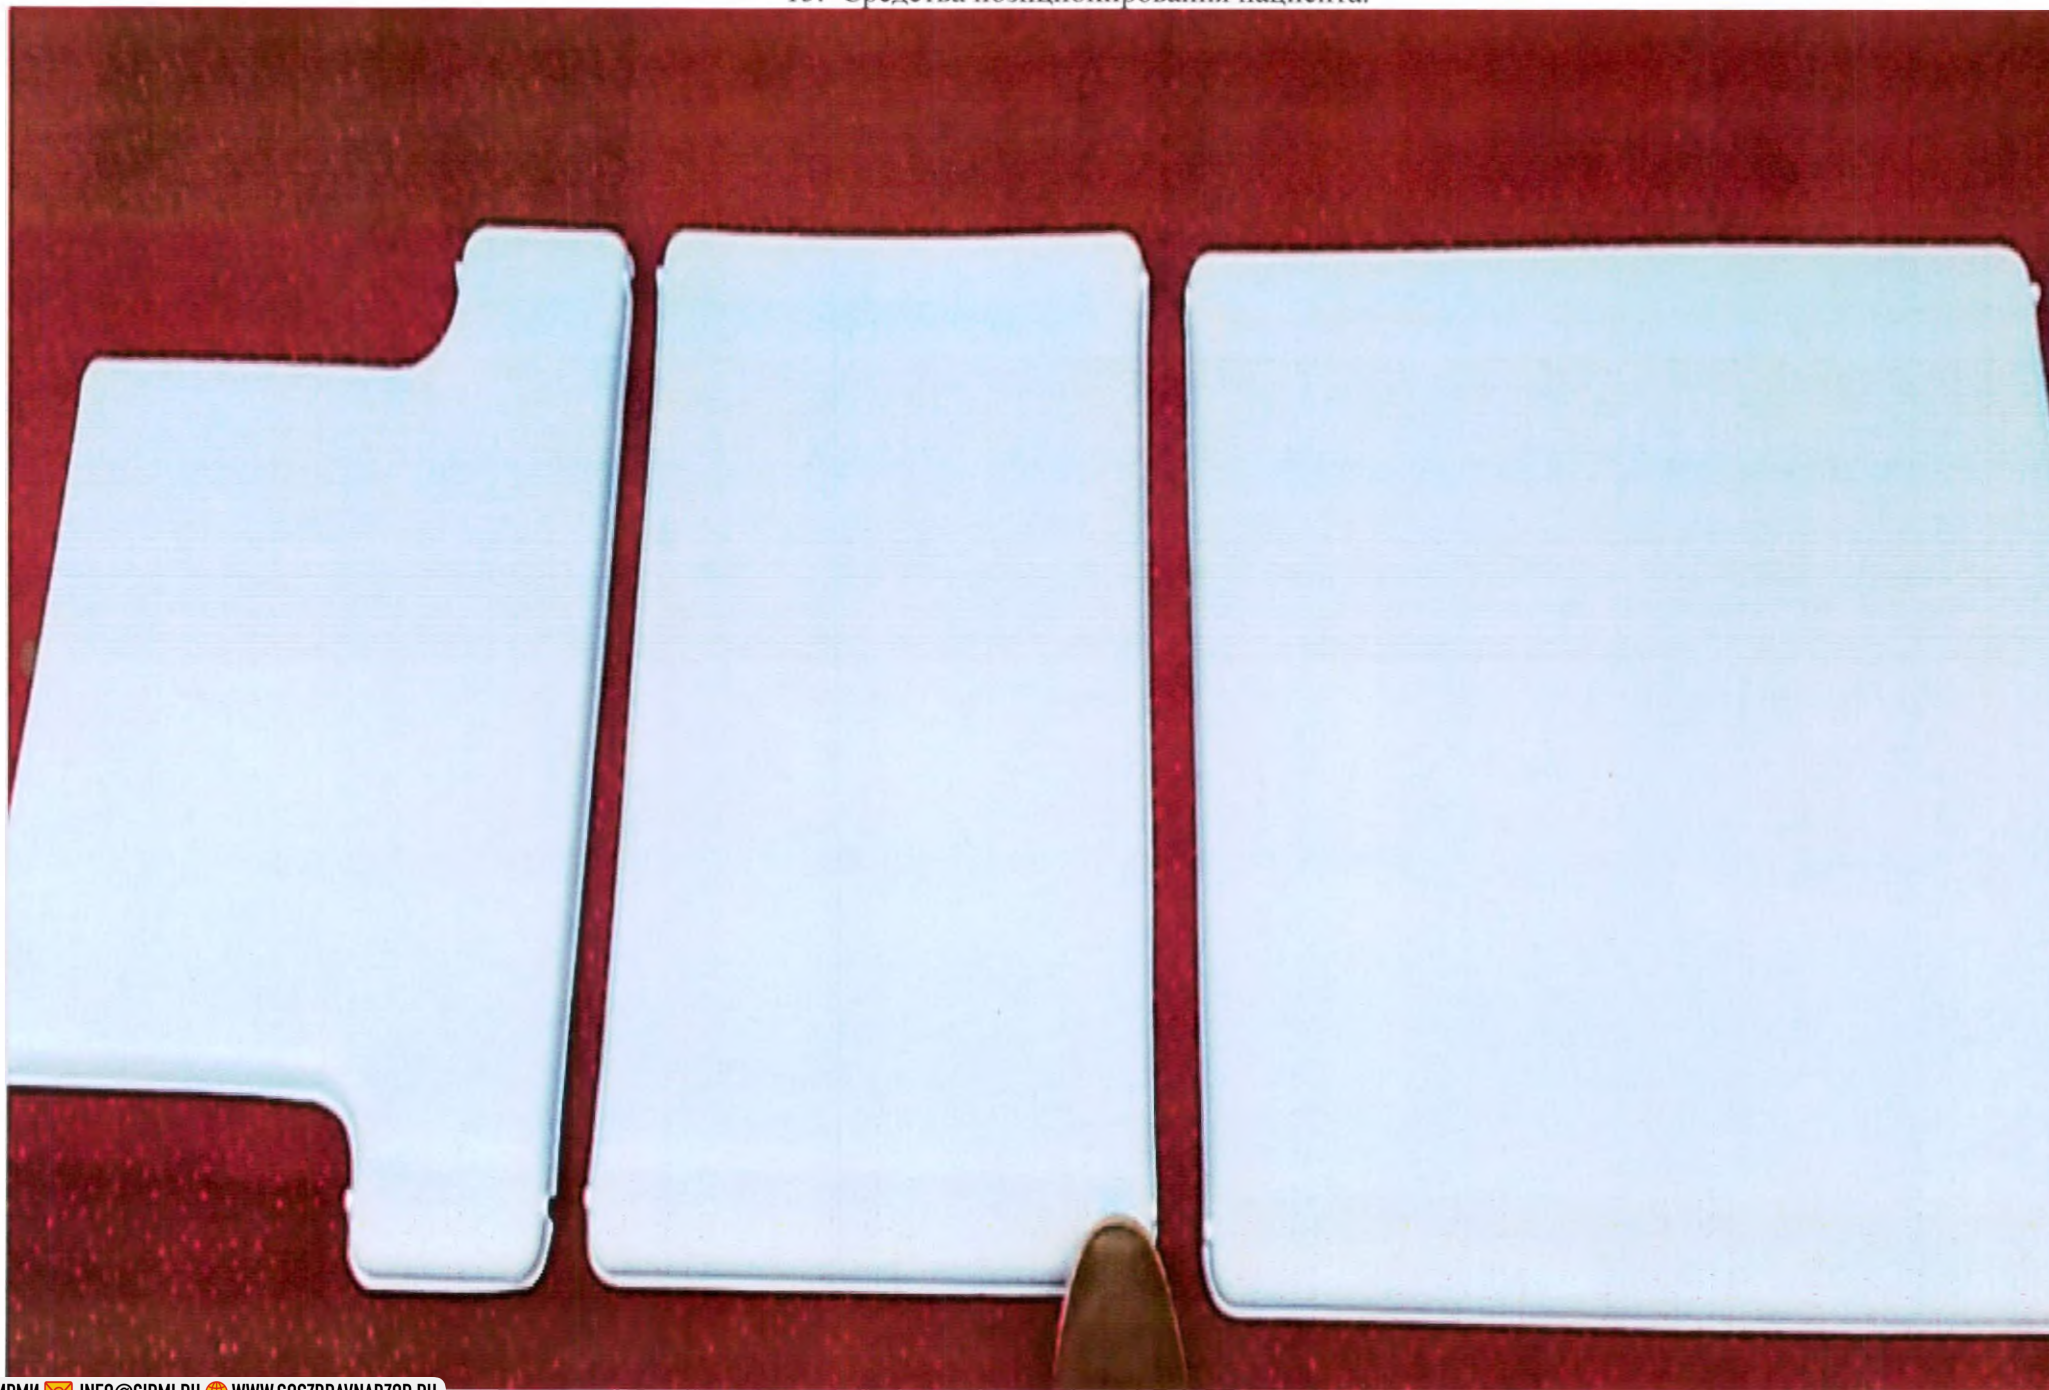

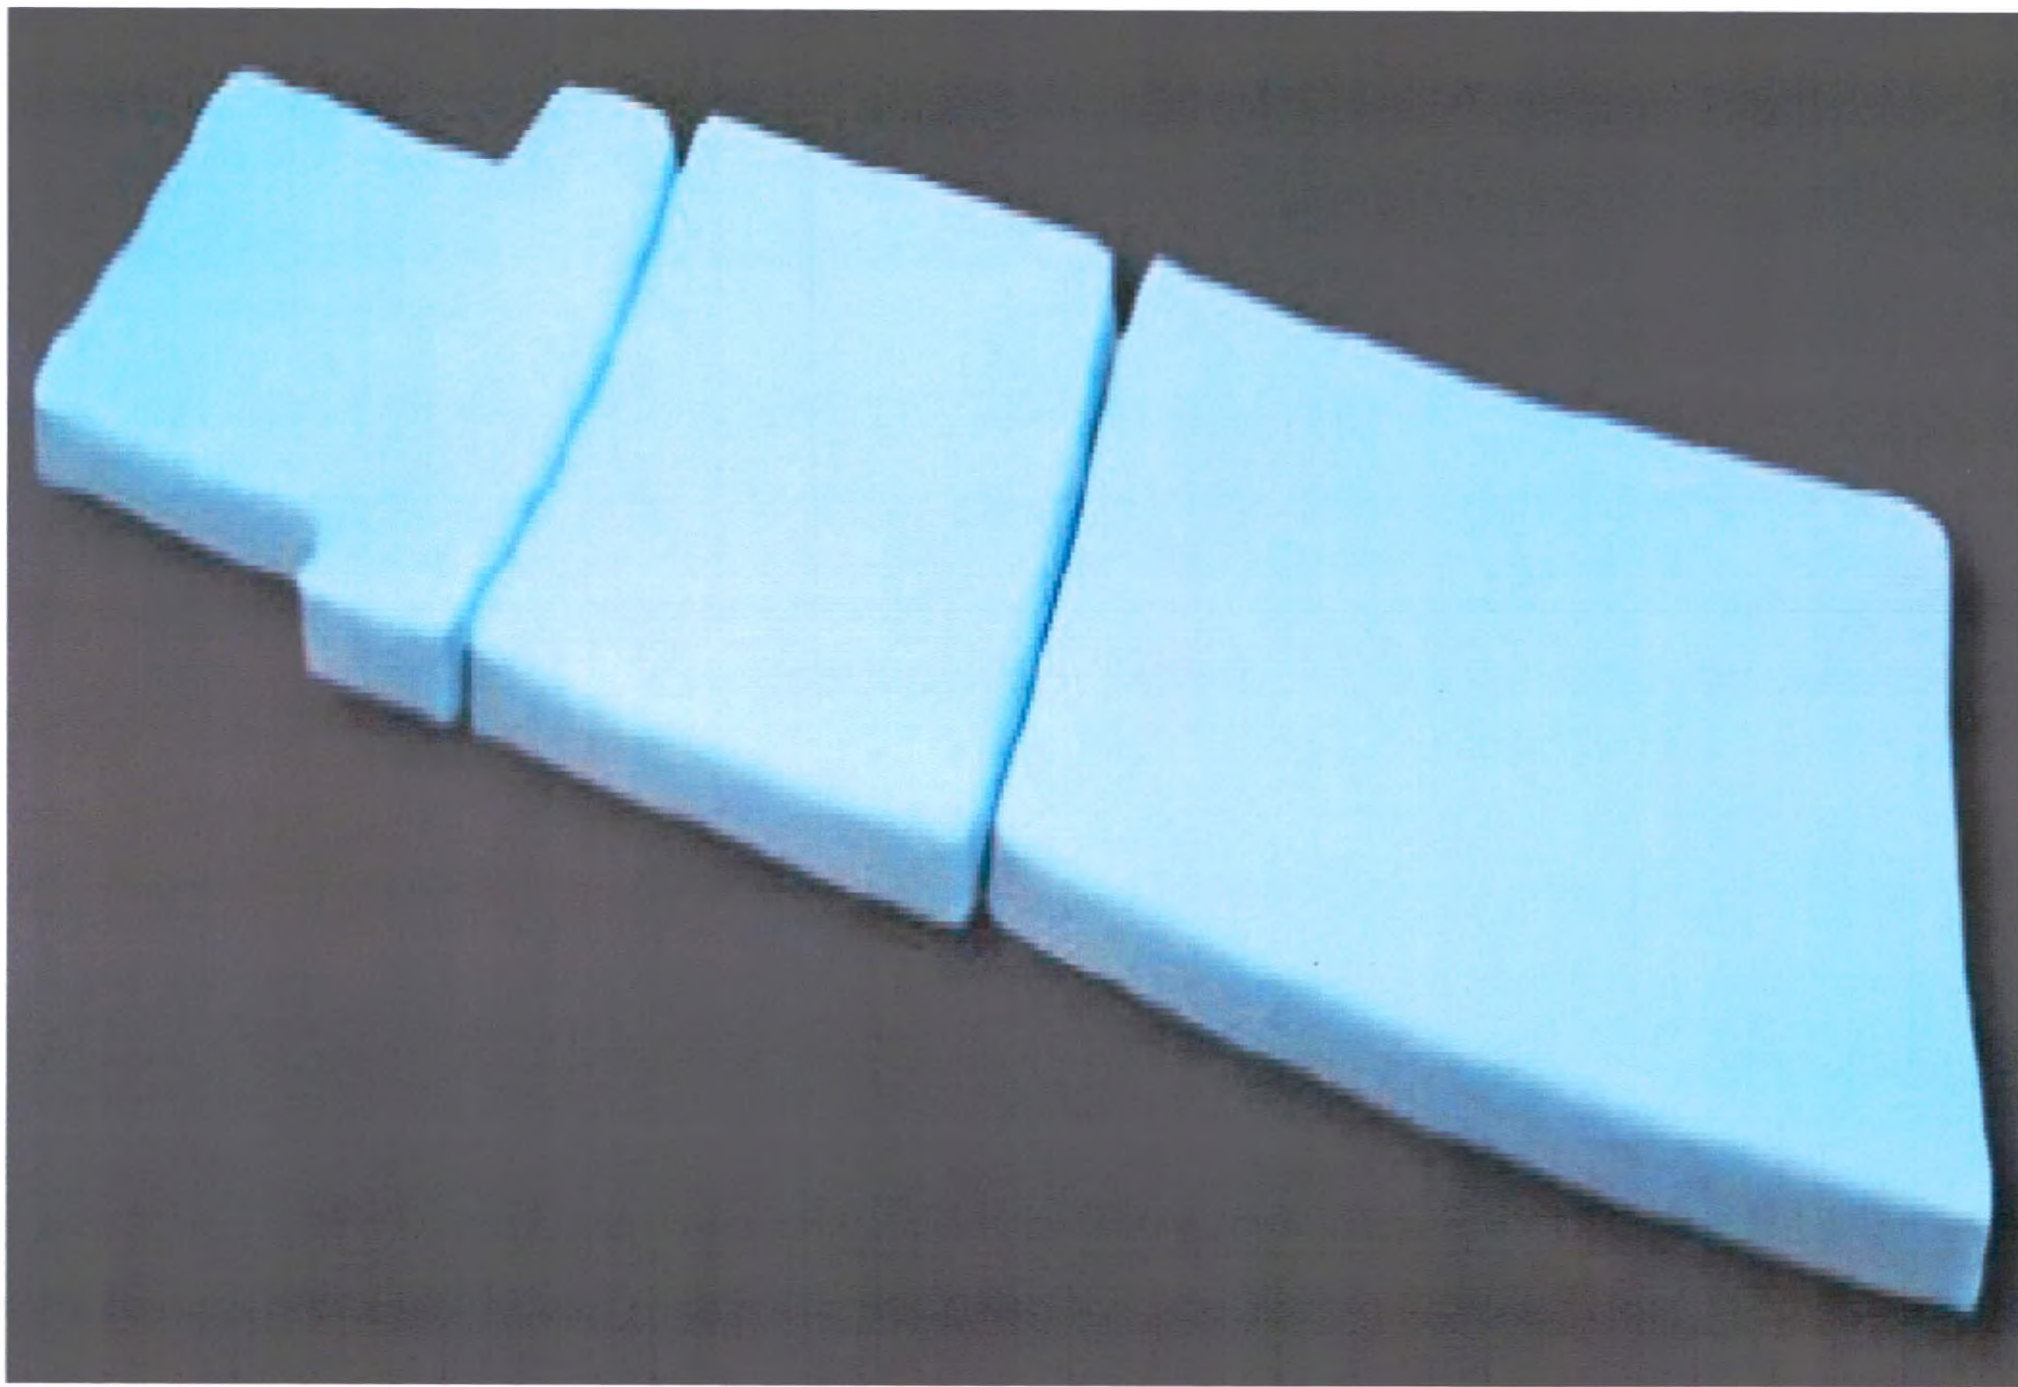

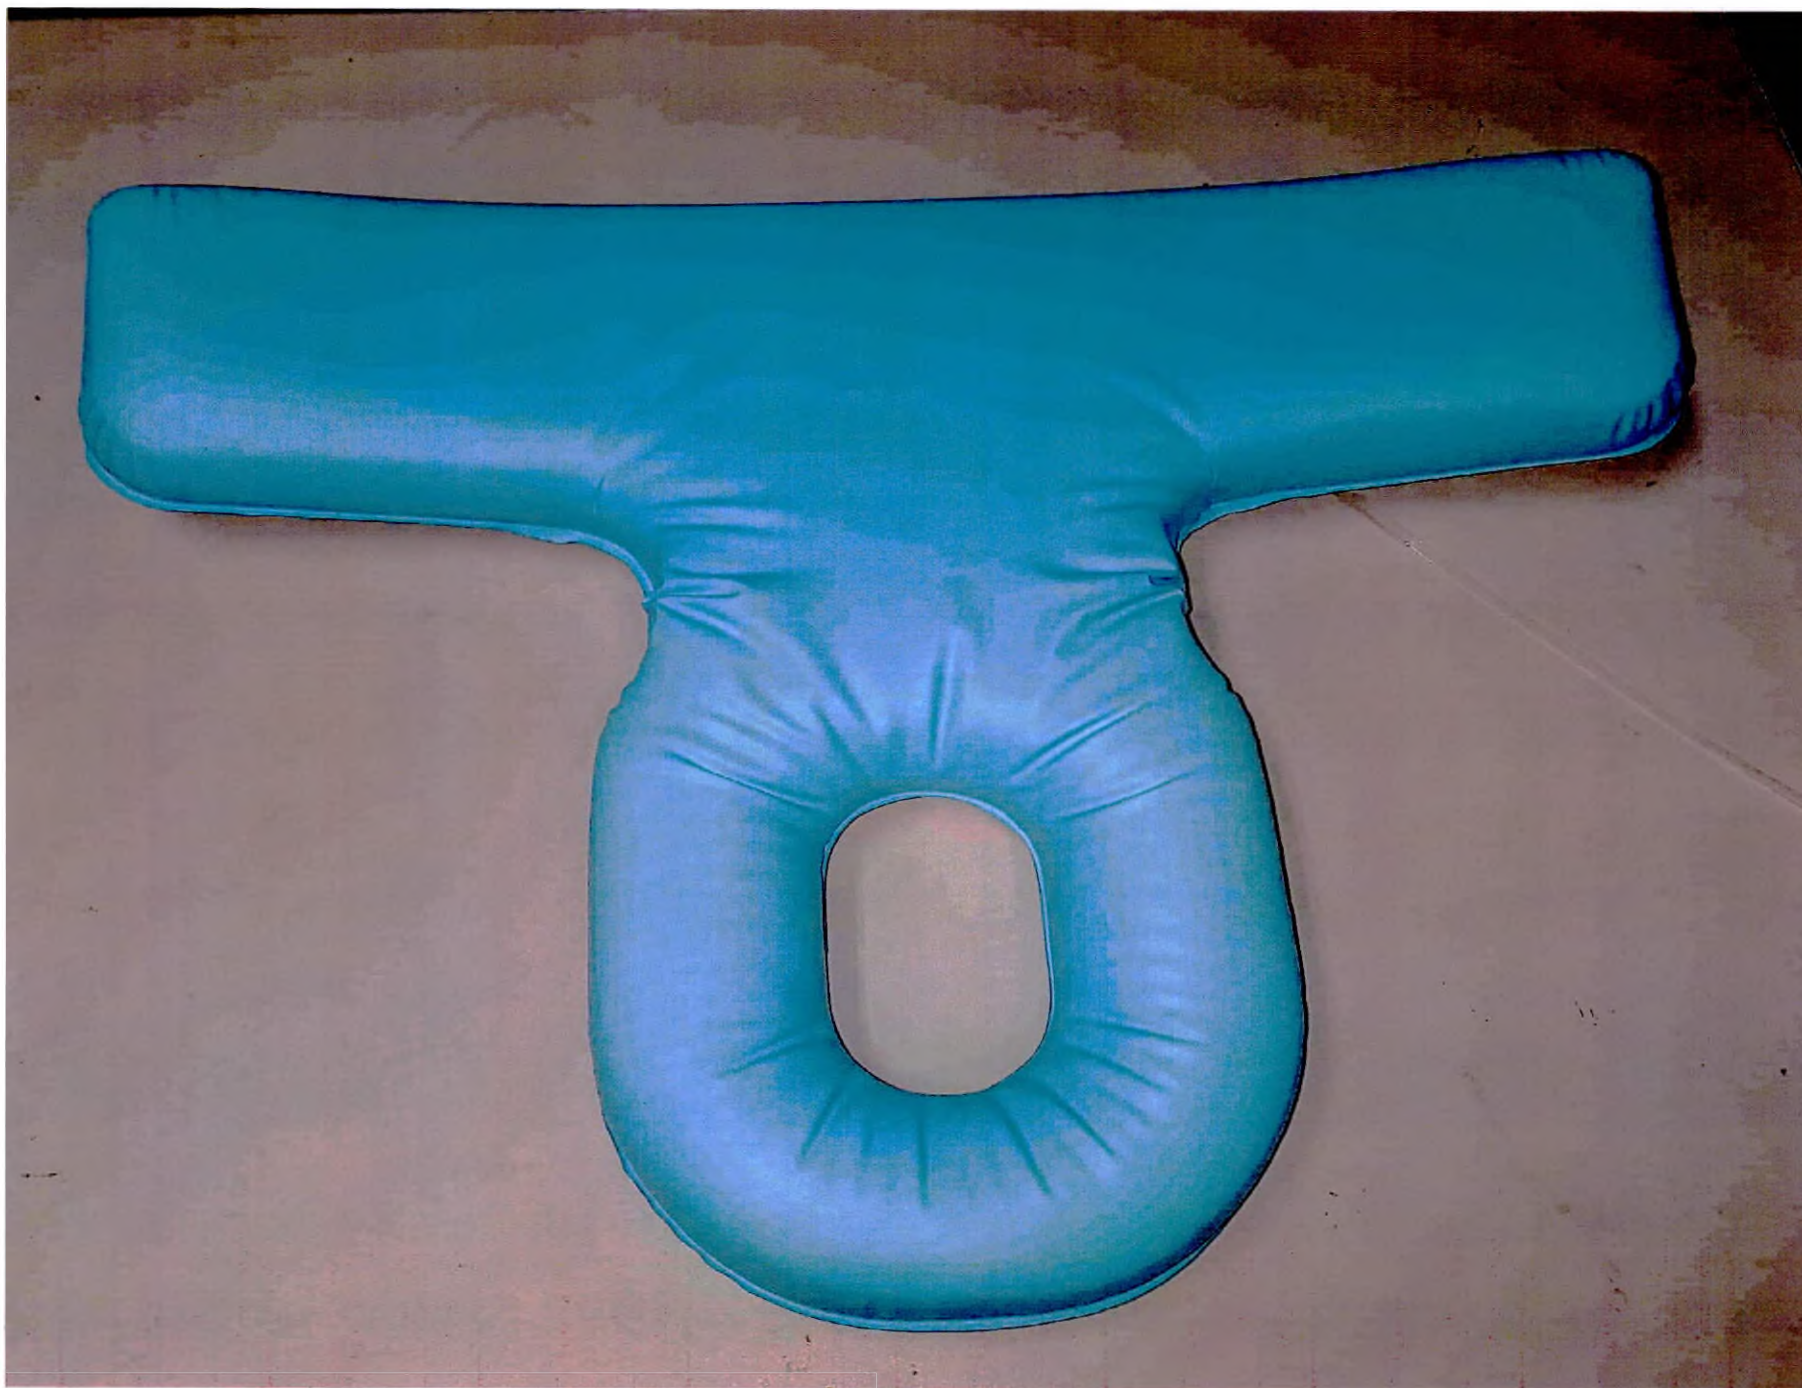

15.3. Прокладка для фиксации NVC.






15.5. Клин 30°.





15.6. Клин 15°.

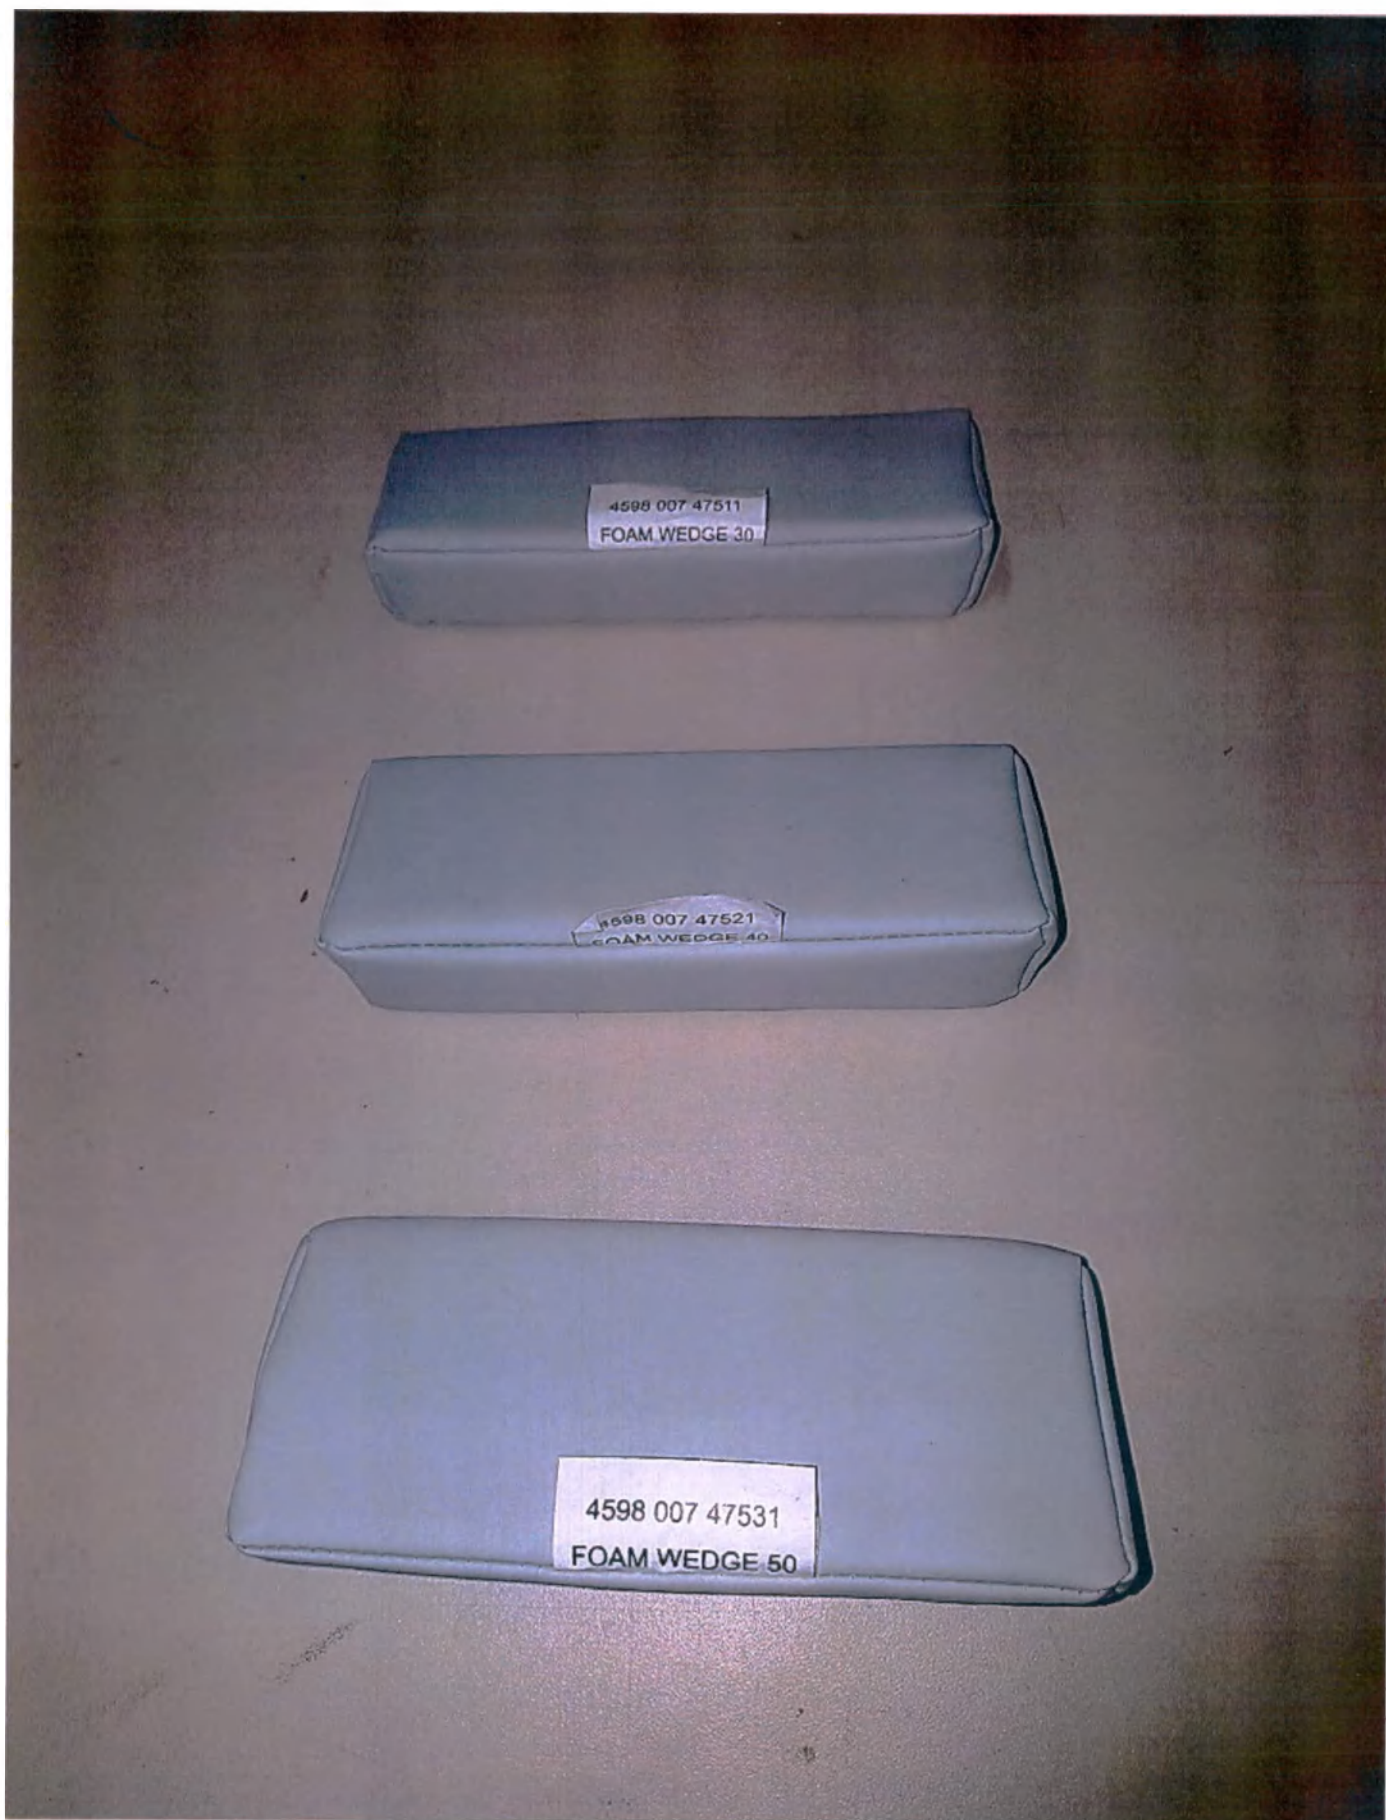

15.7. Клин из пеноматериала.



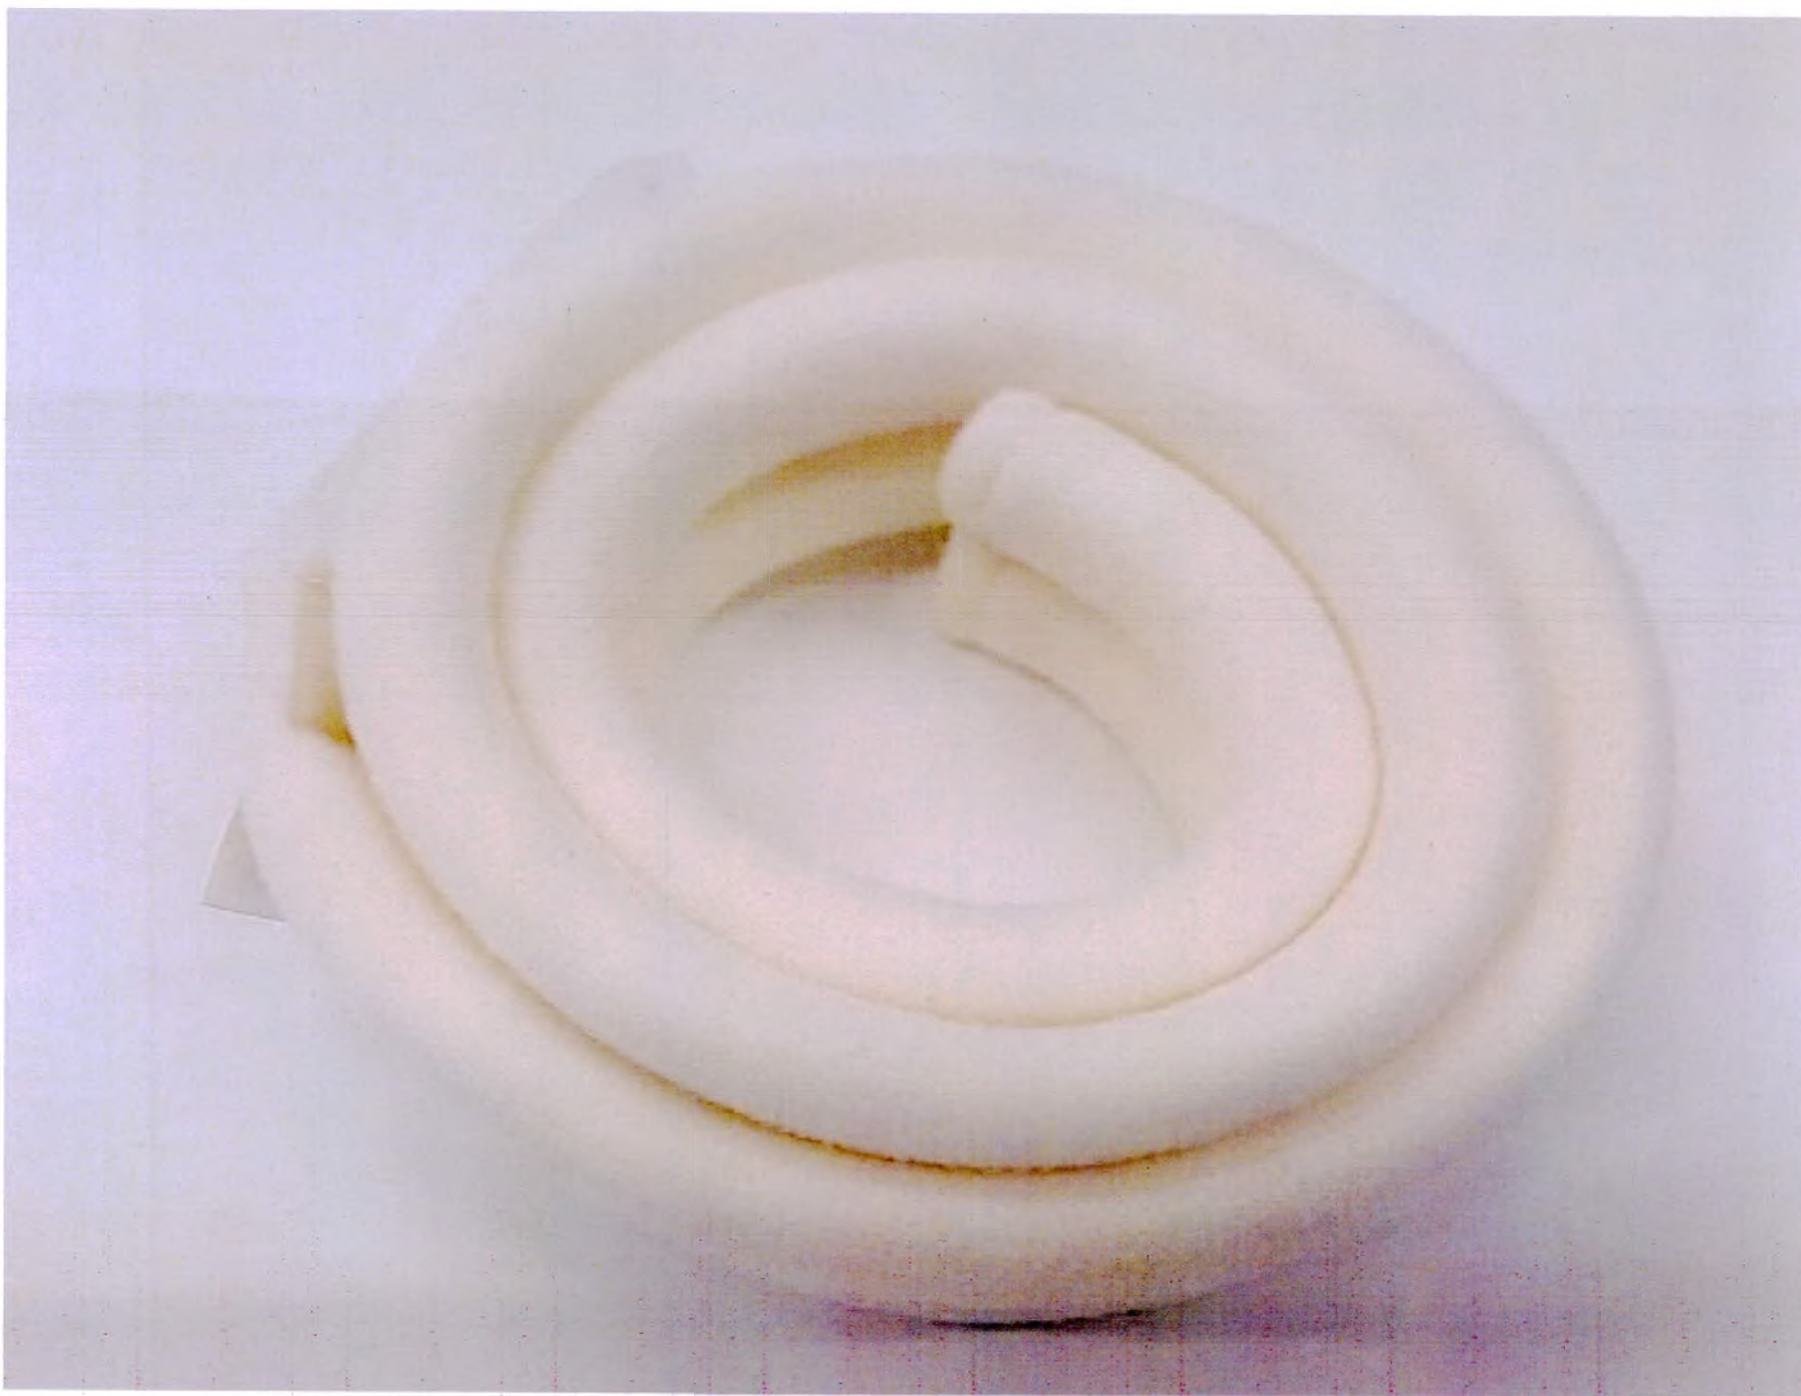


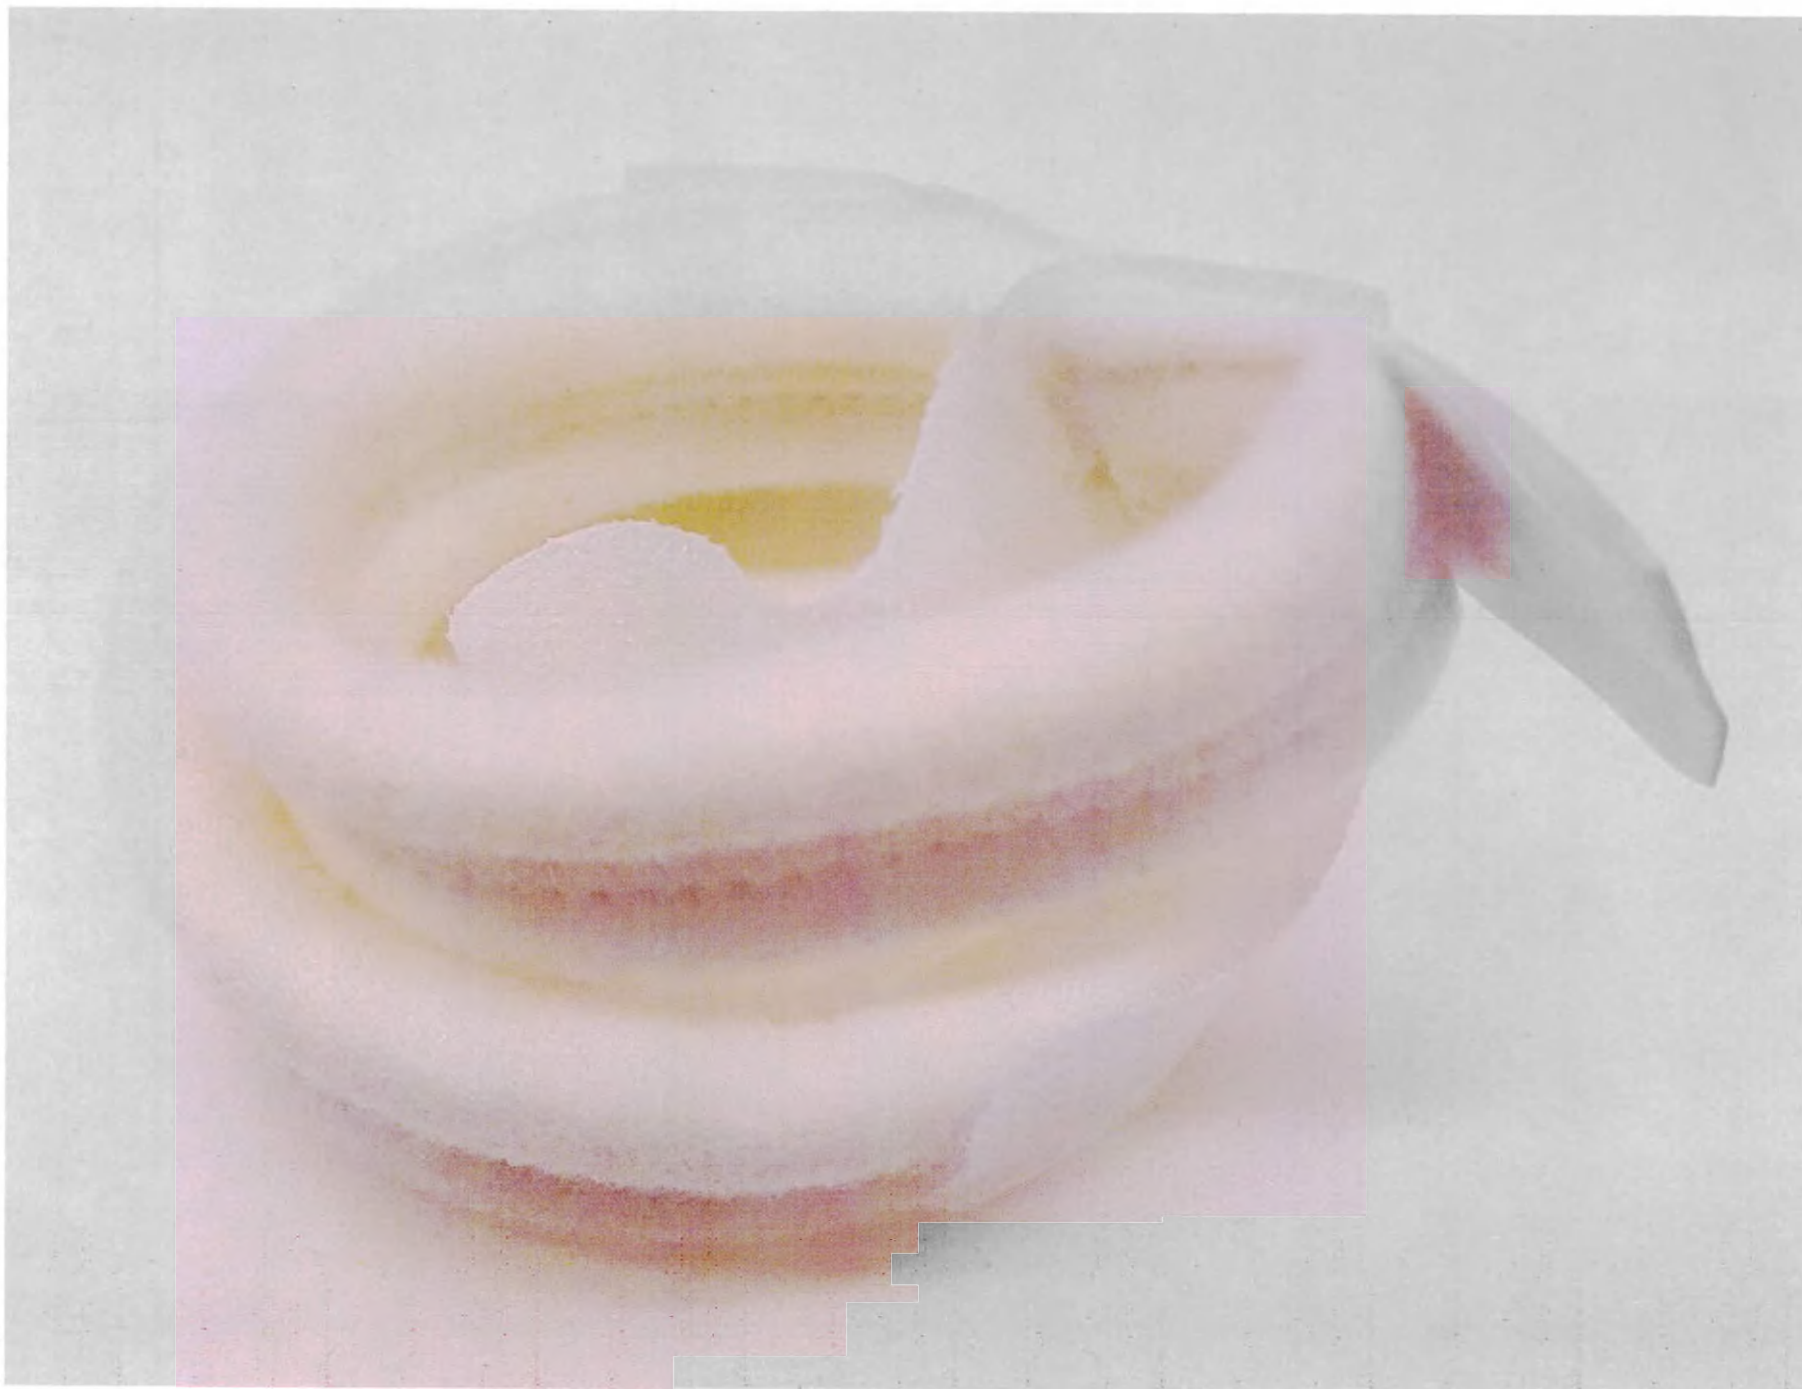







7

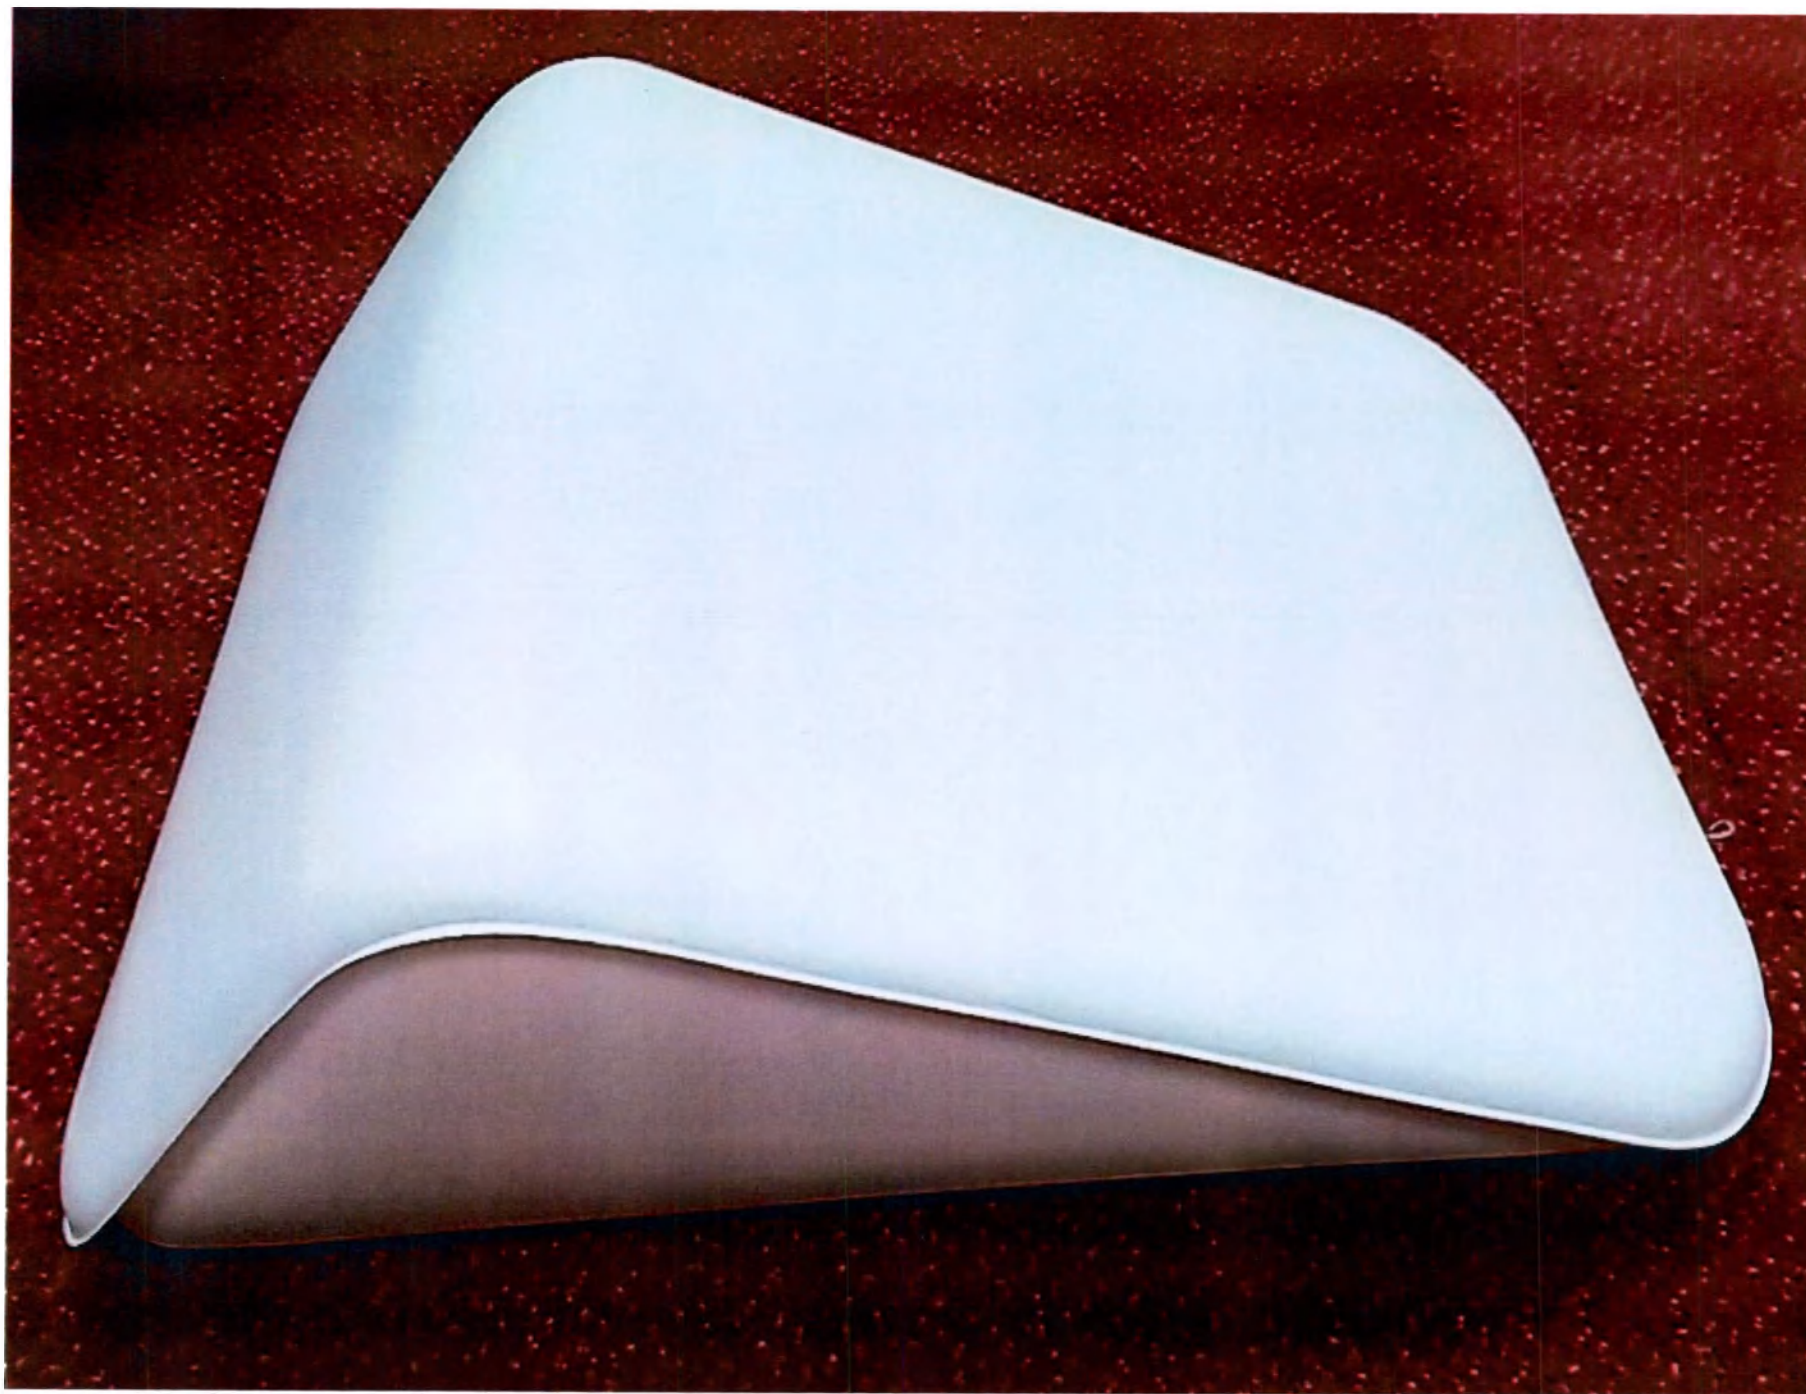


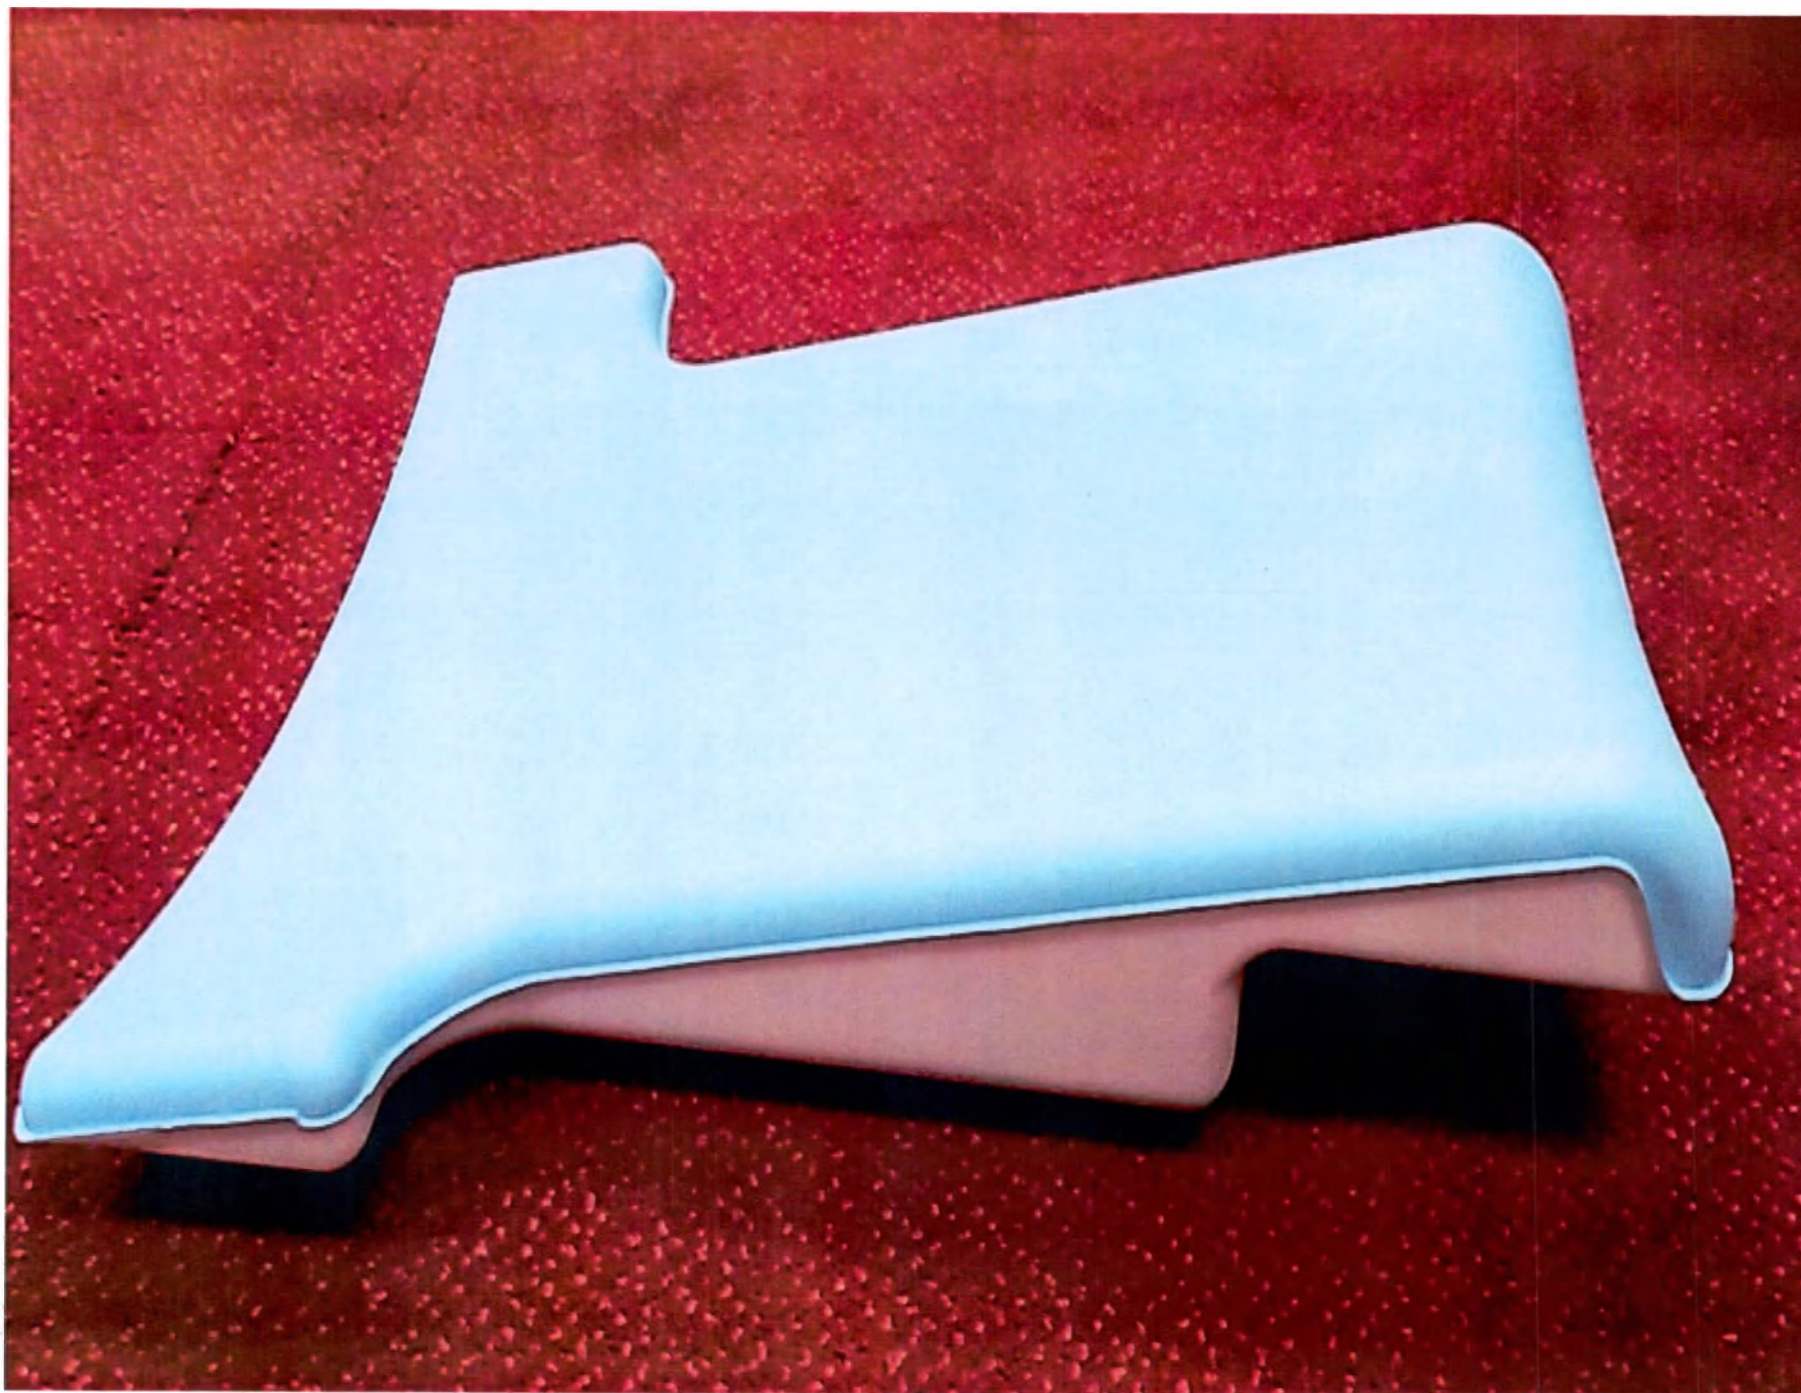

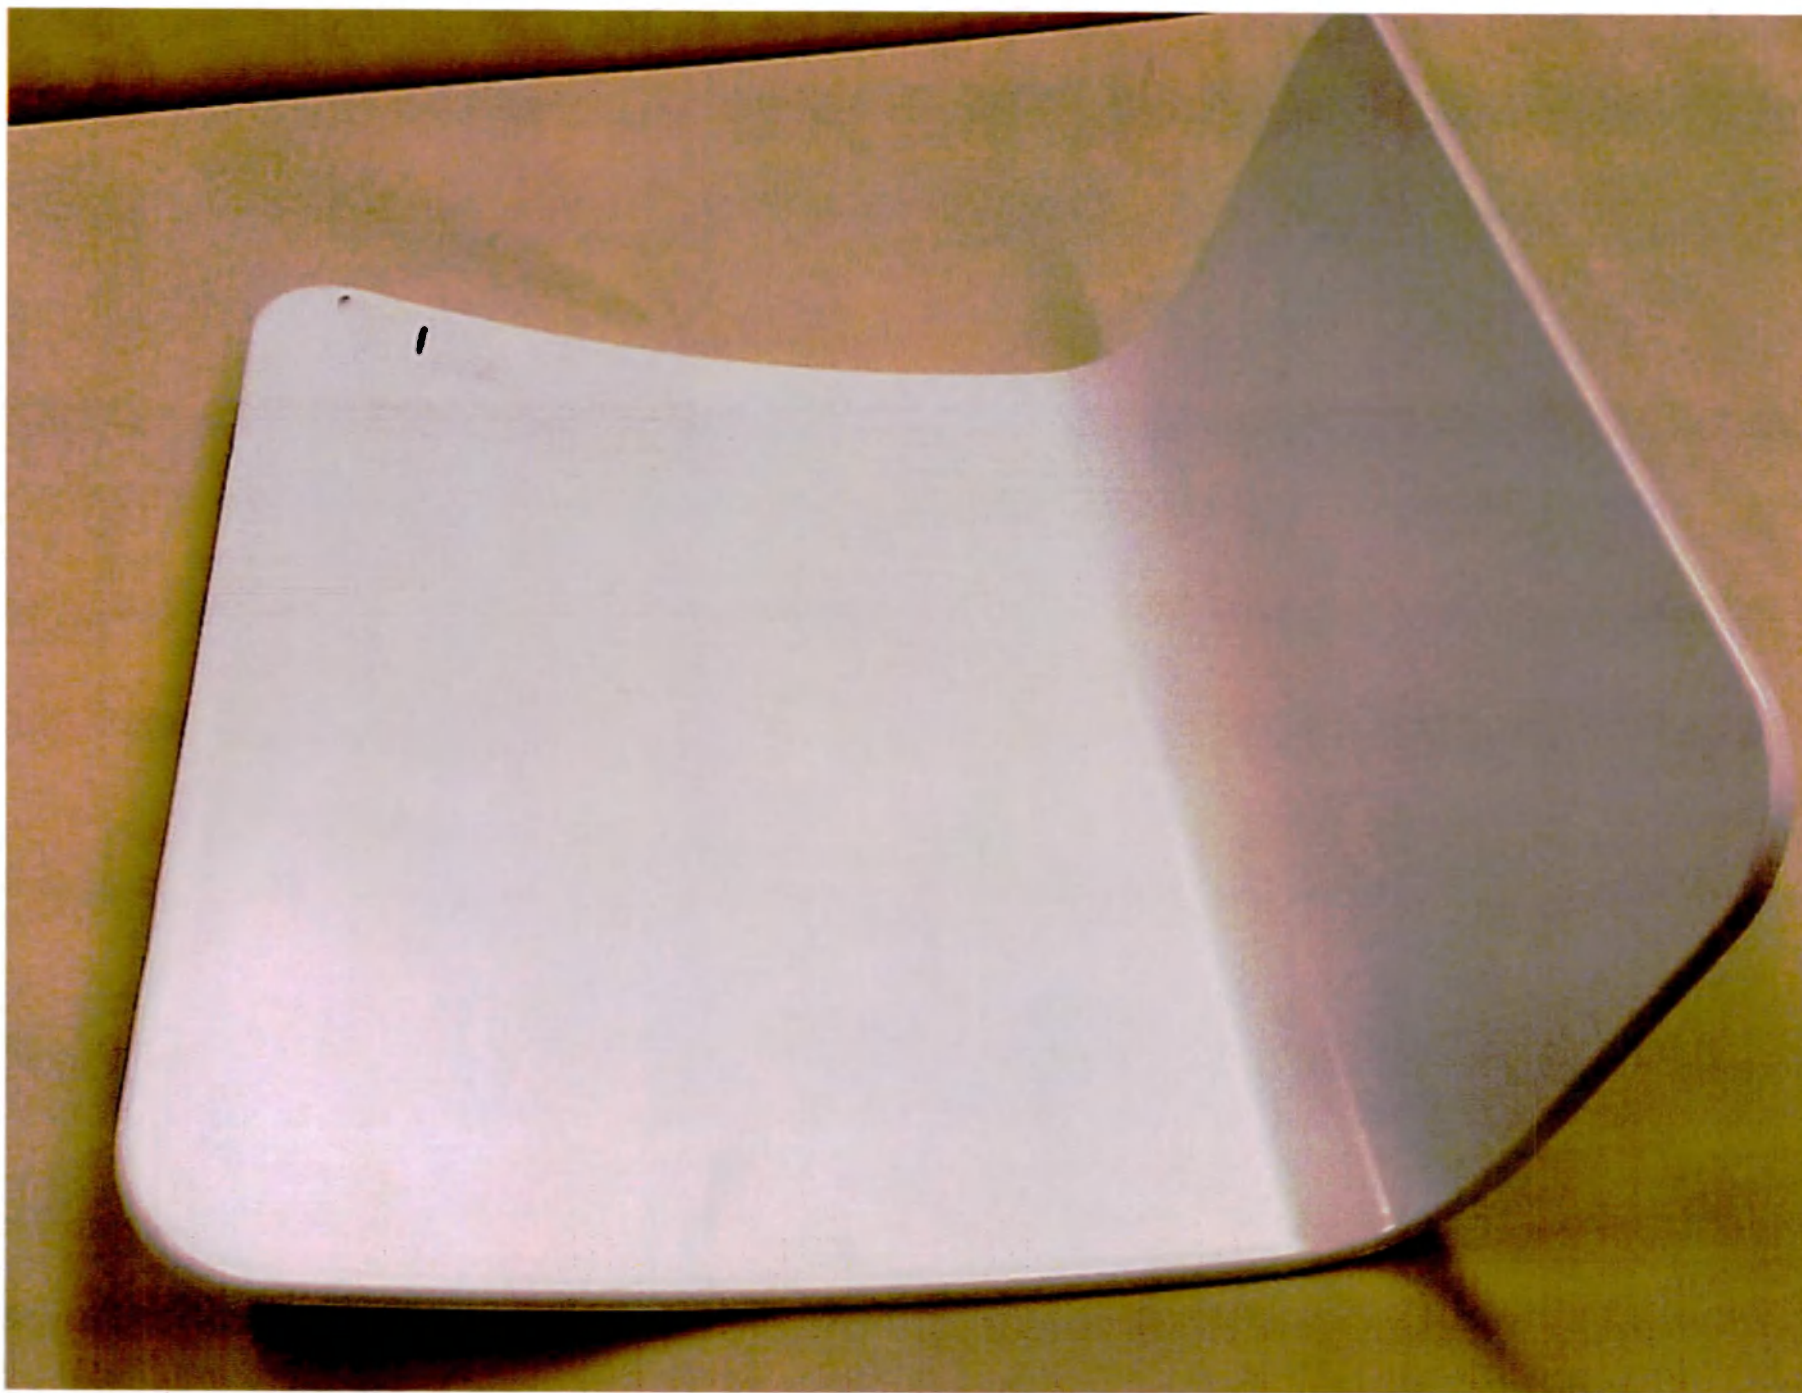







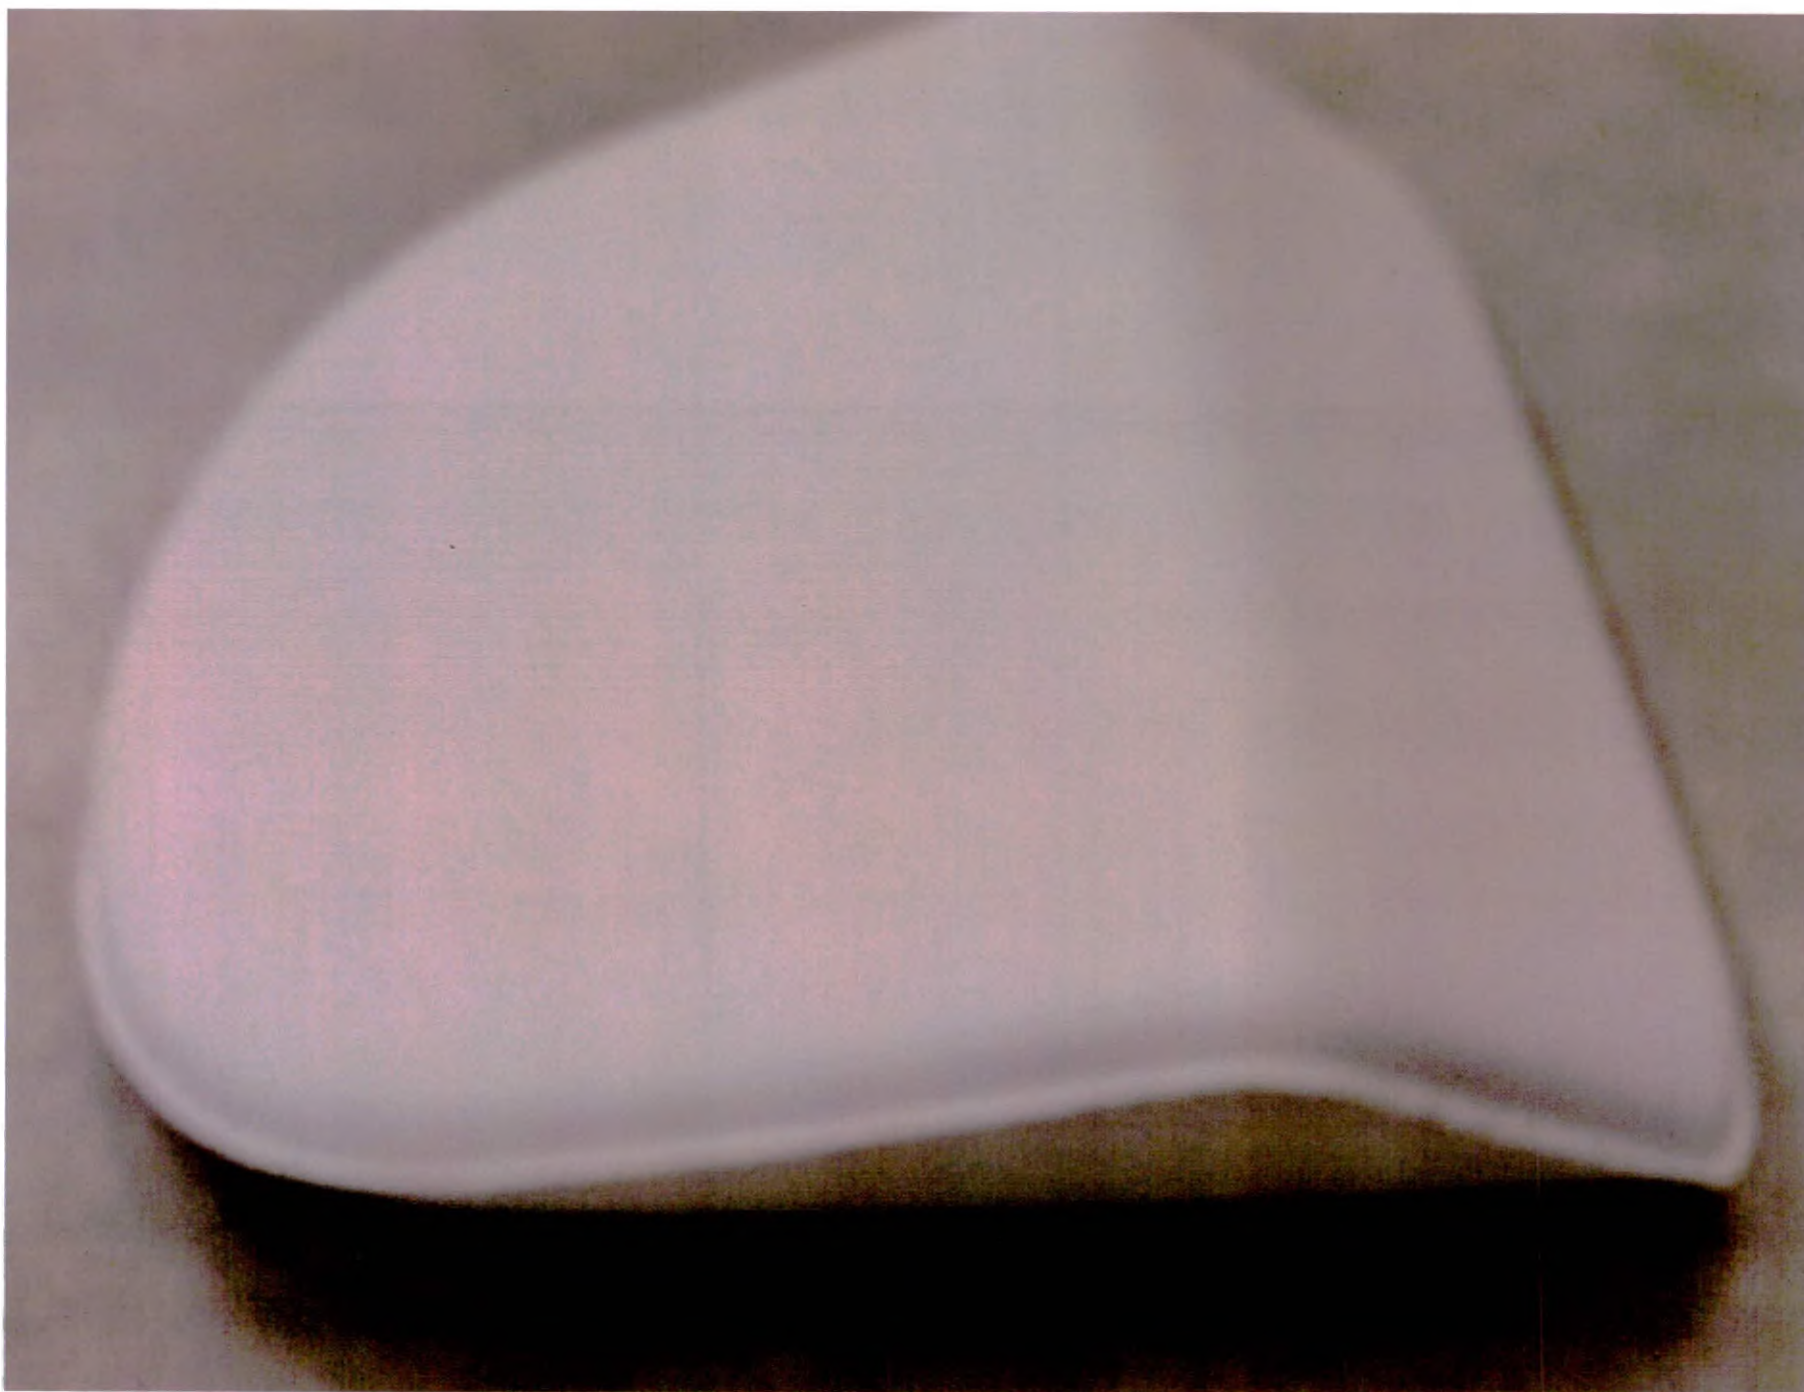



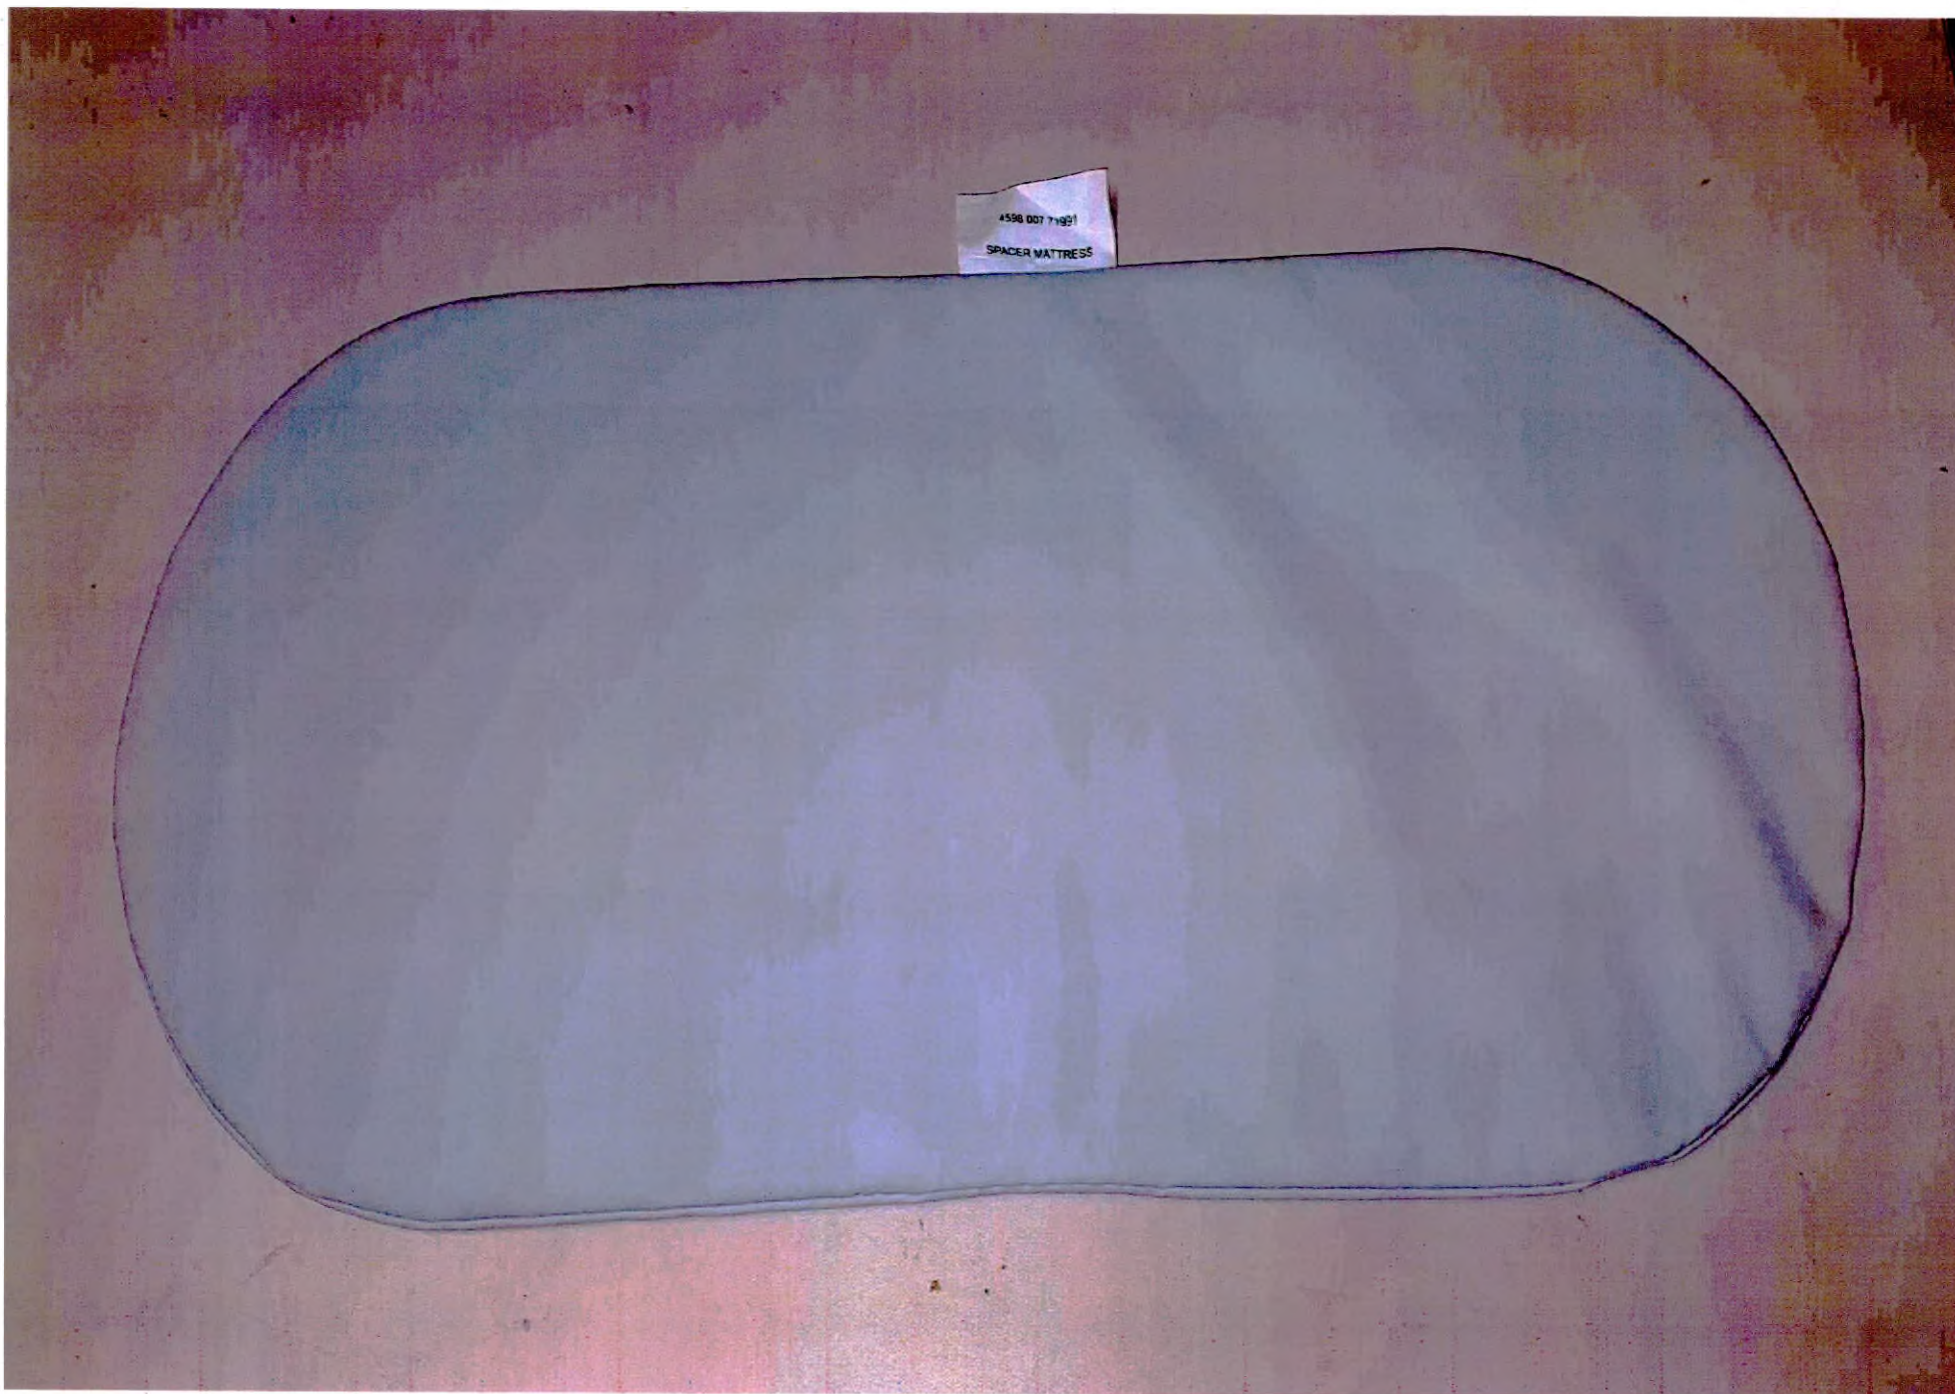

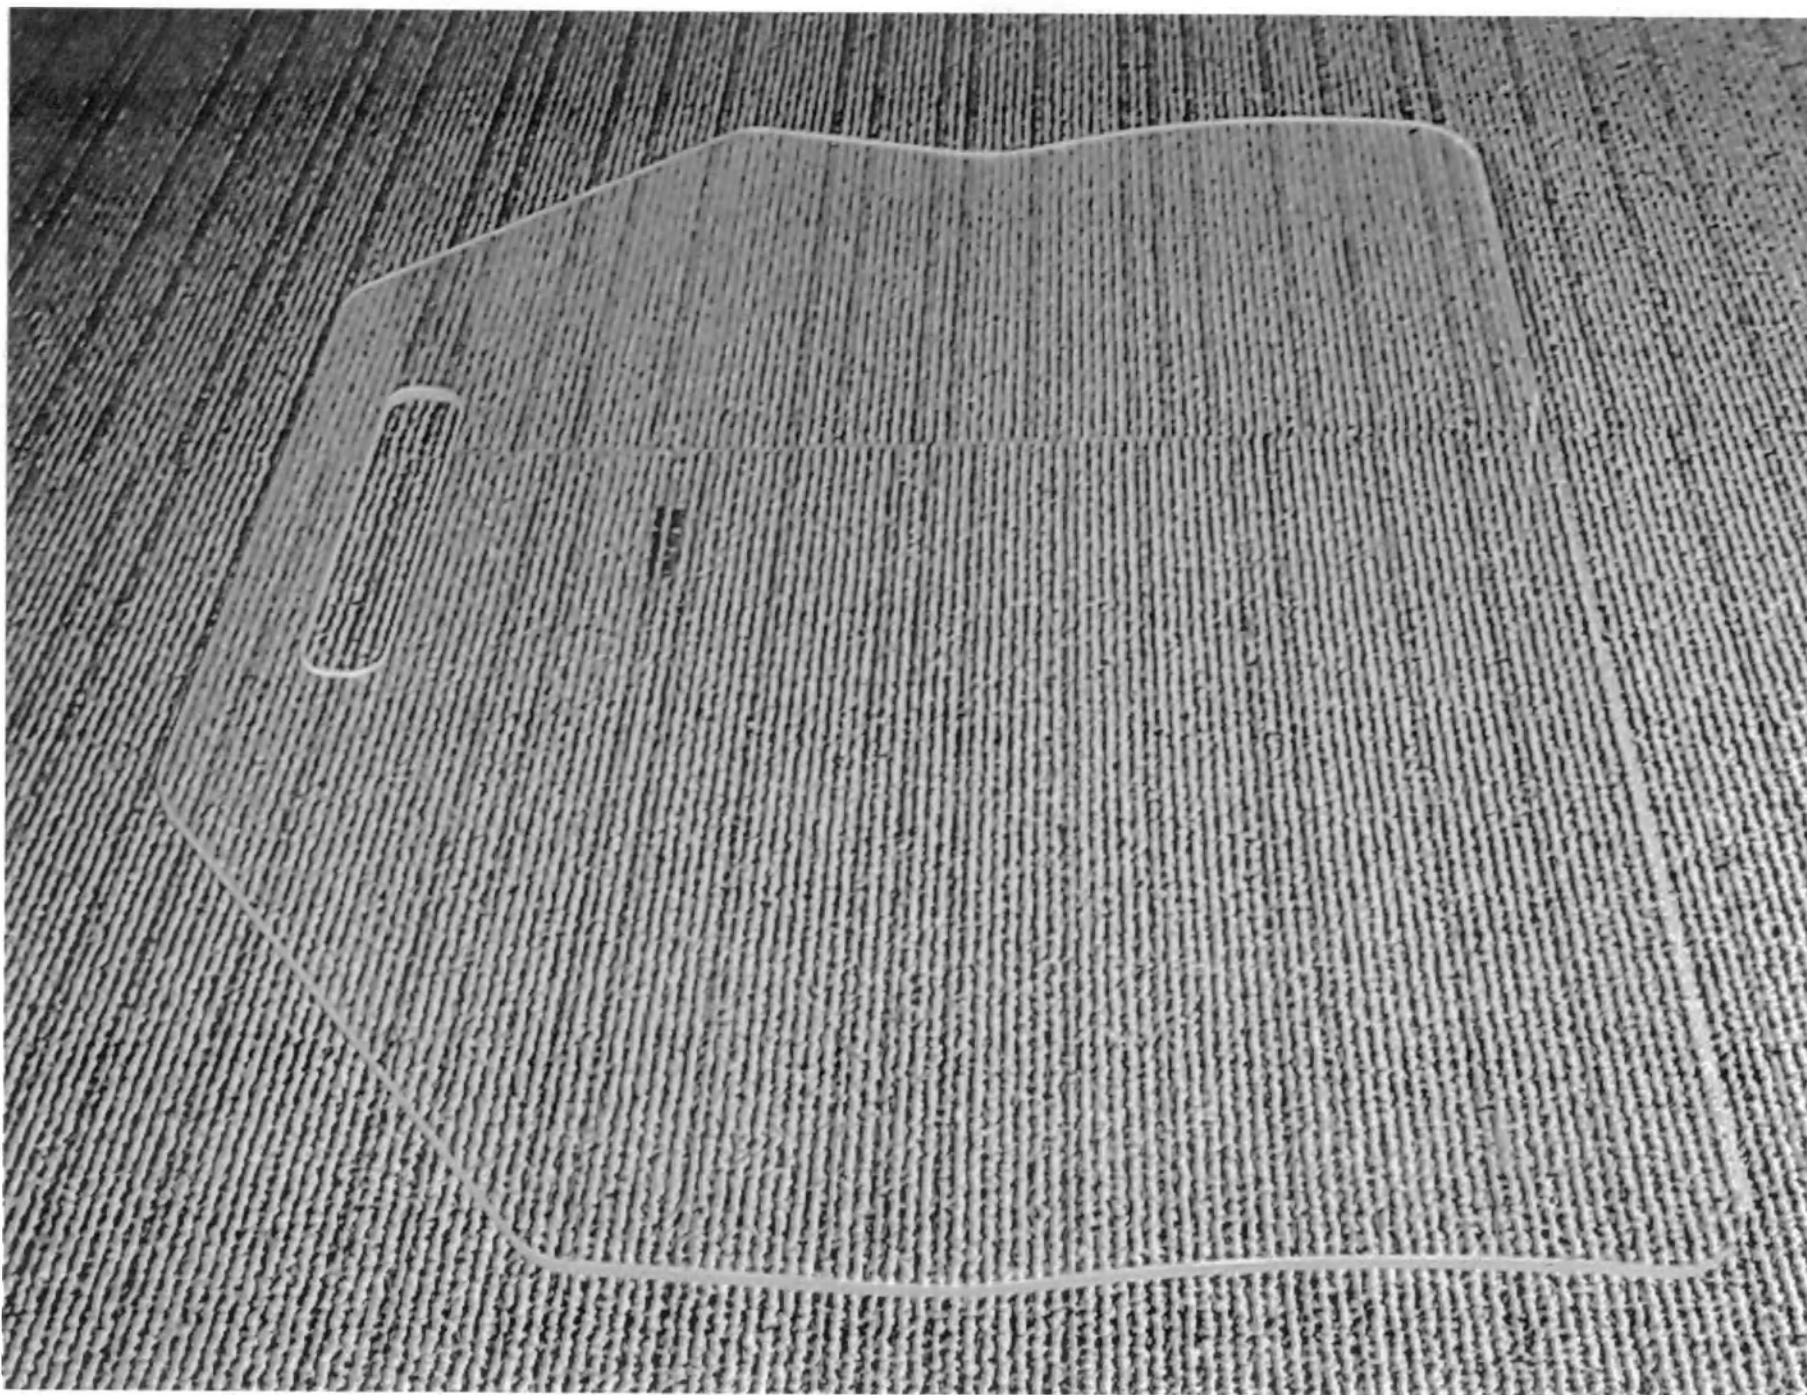




15.23. Фиксатор для ног.








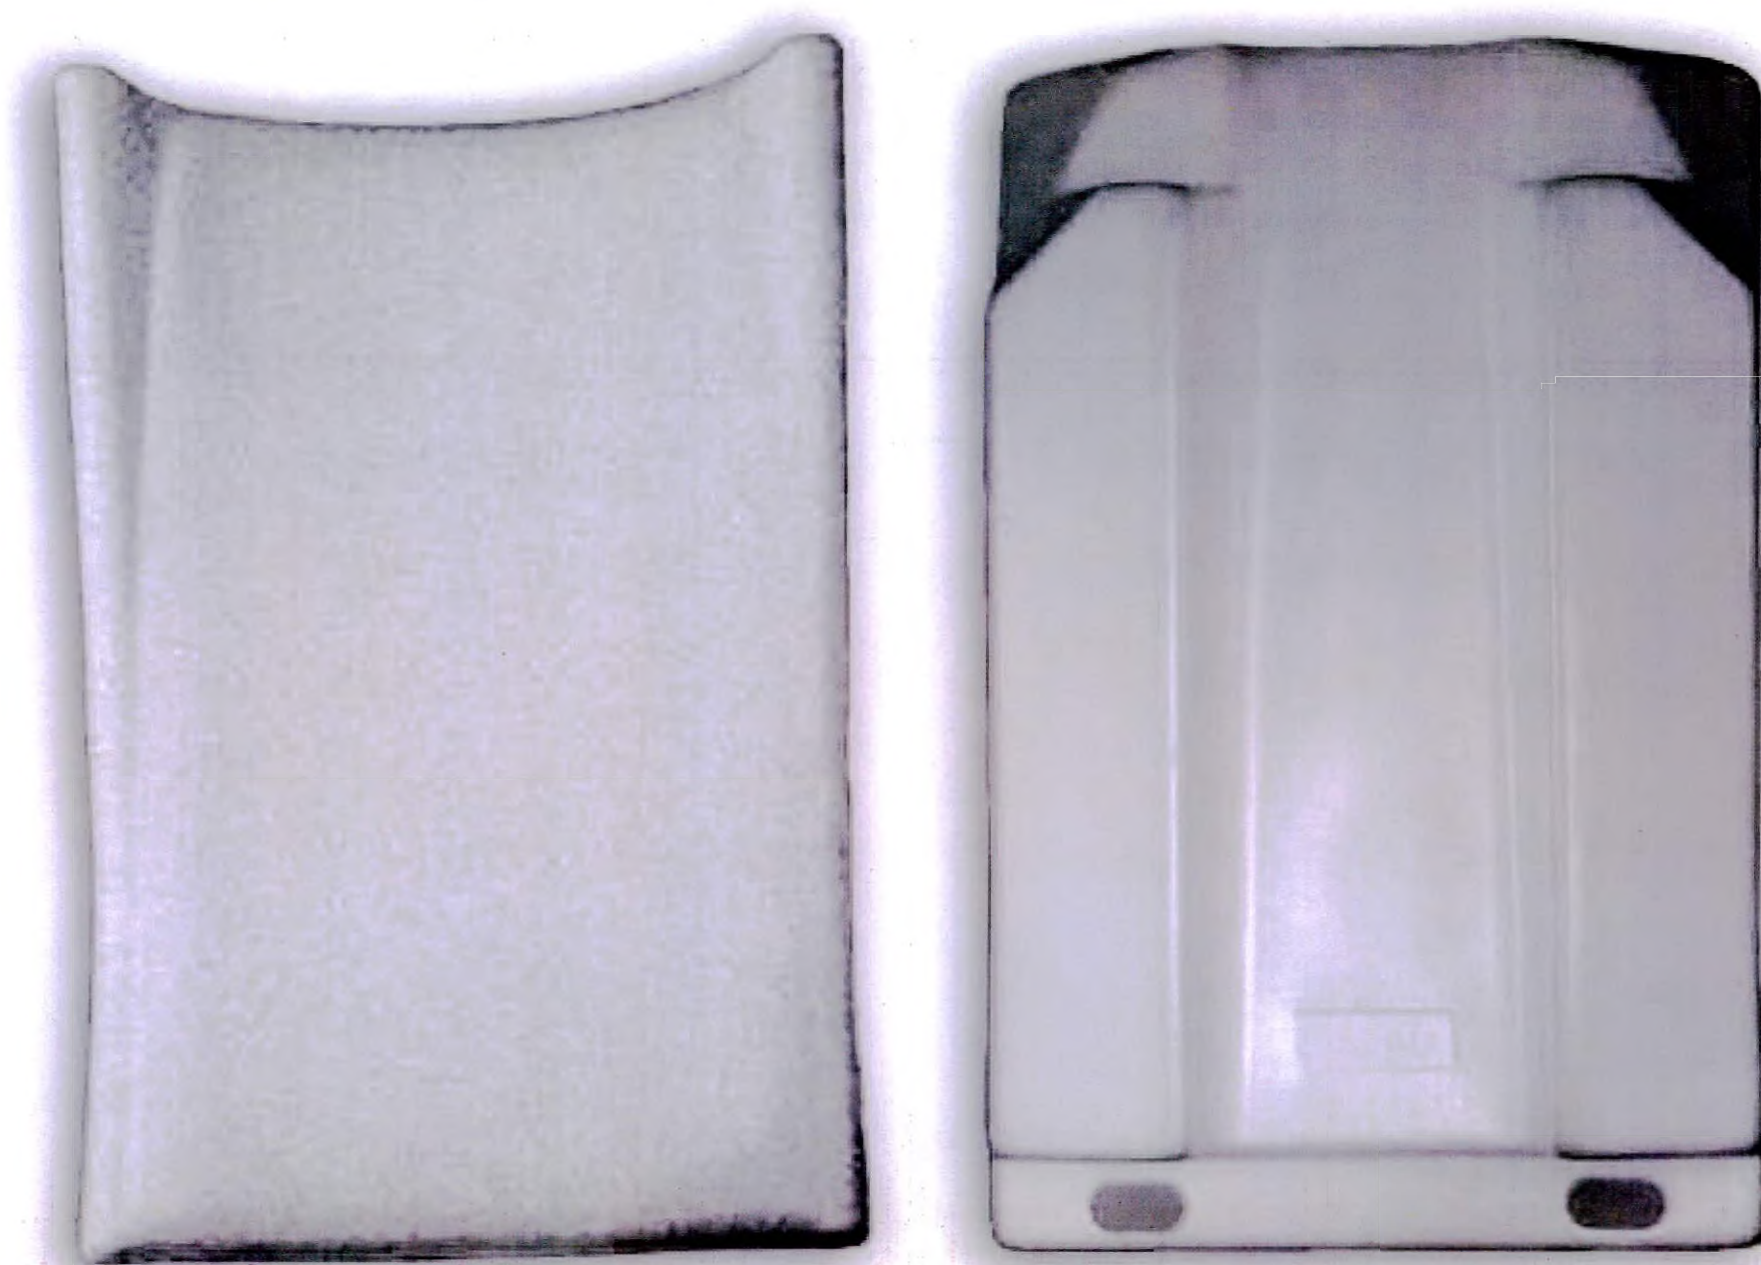

15.25. Прокладка для молочных желез. Опора на липучках снизу.



15.25. Прокладка для молочных желез. Надставка опоры с углублением для кабелей.

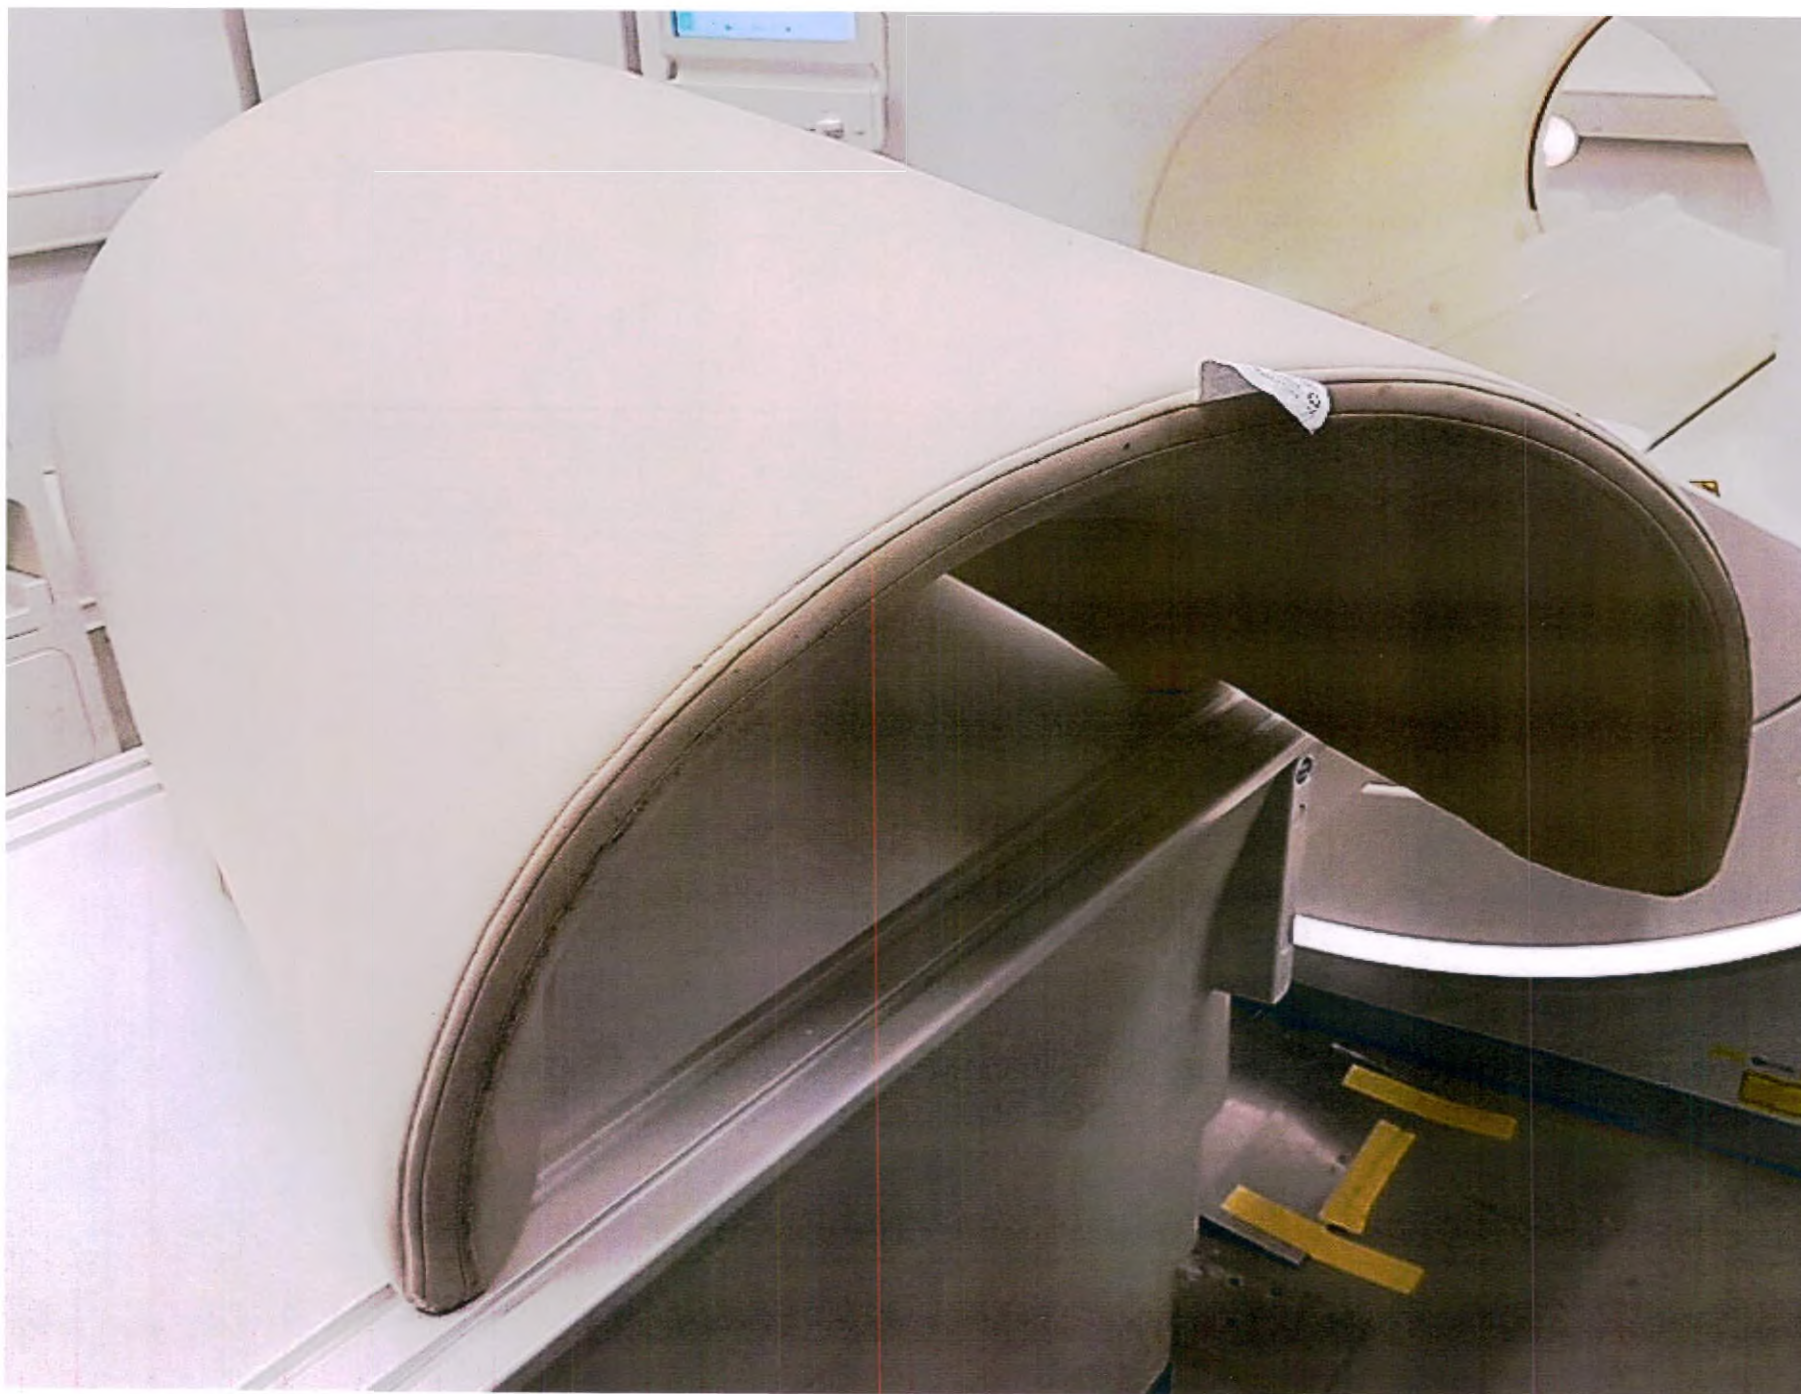









16. Беспроводная система передачи физиологических данных.

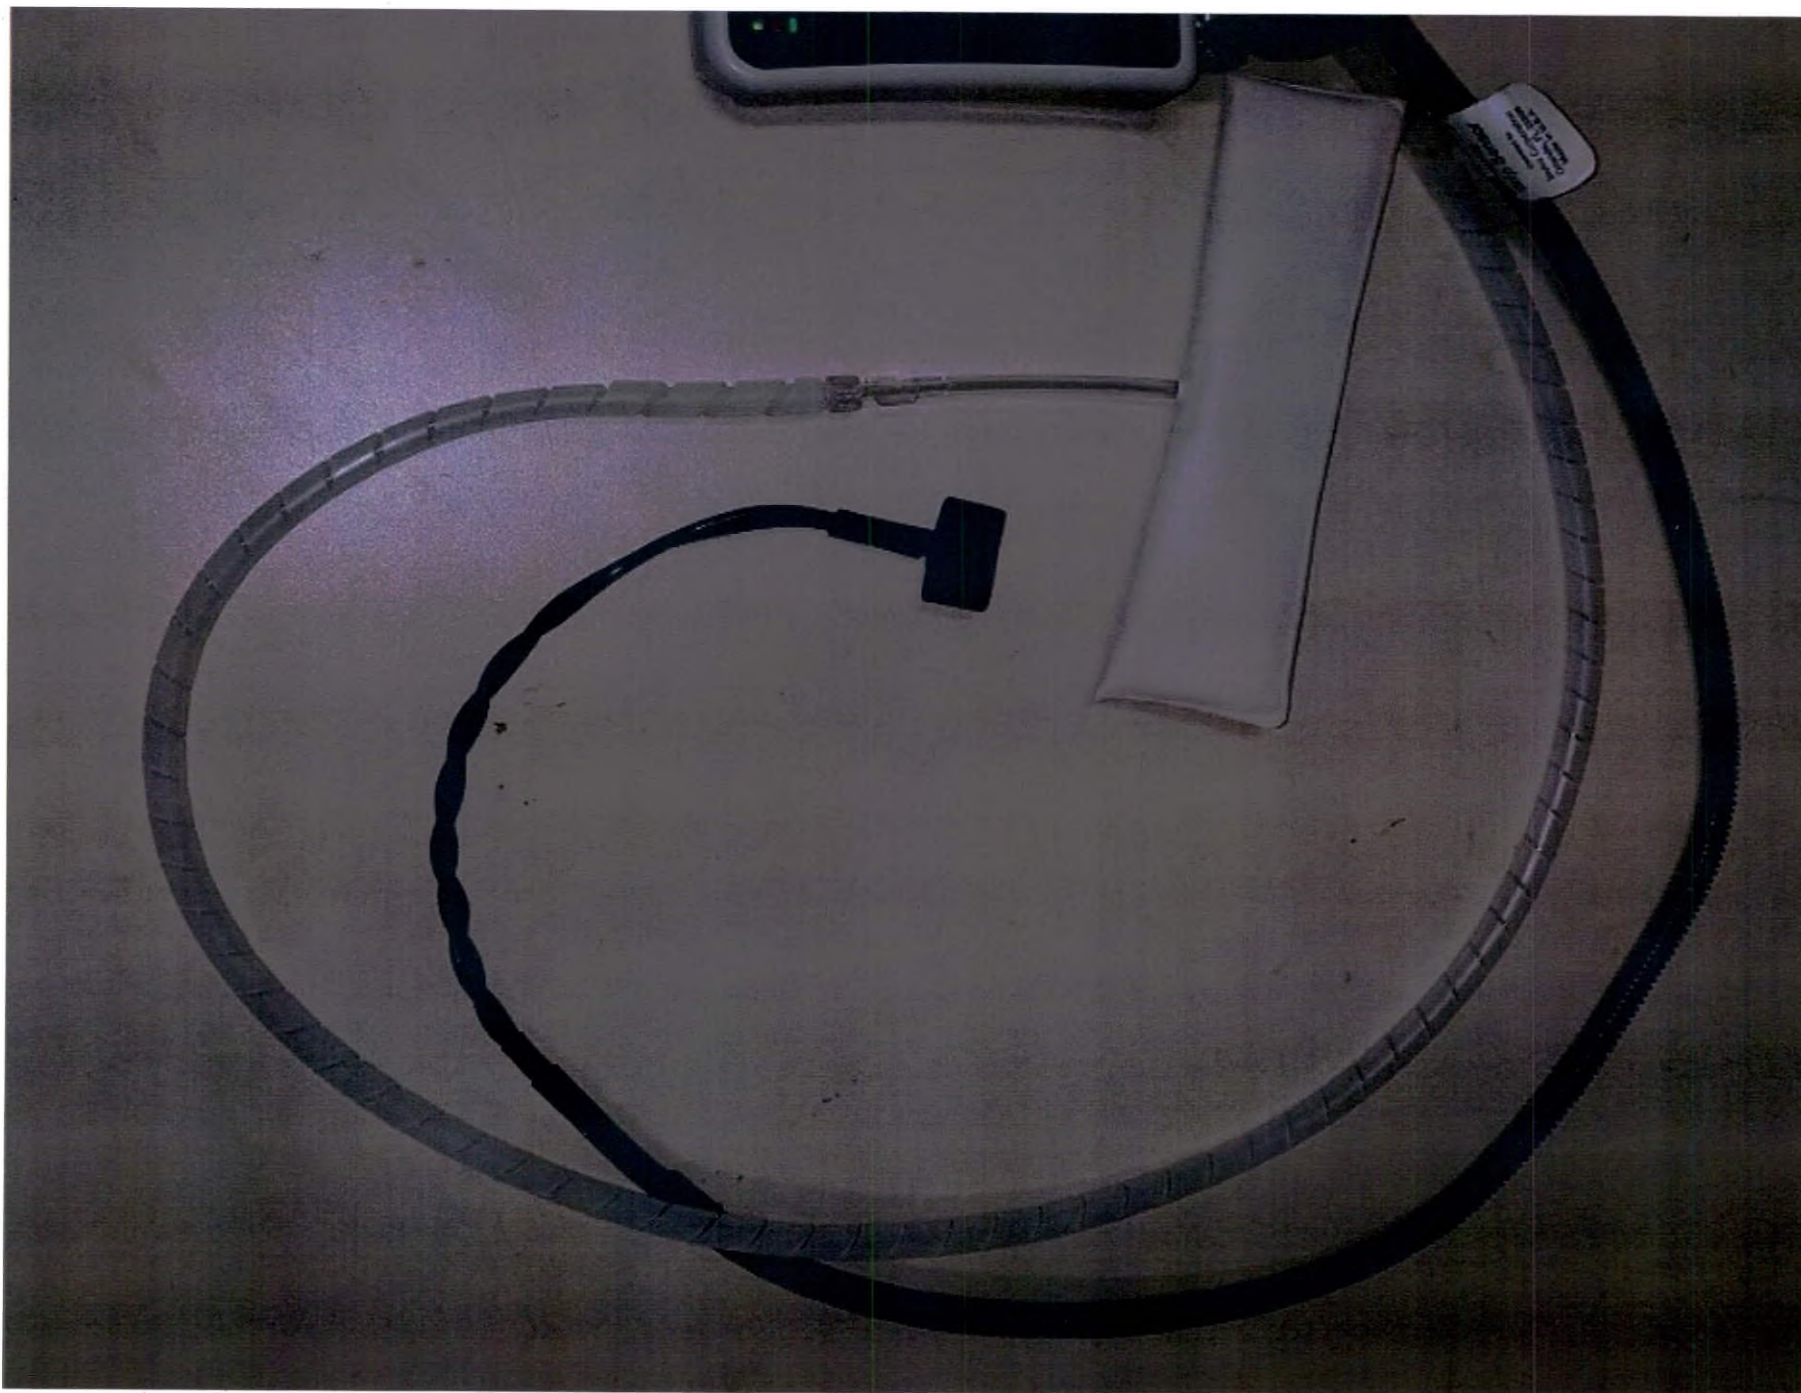


16.1. Датчик дыхания.

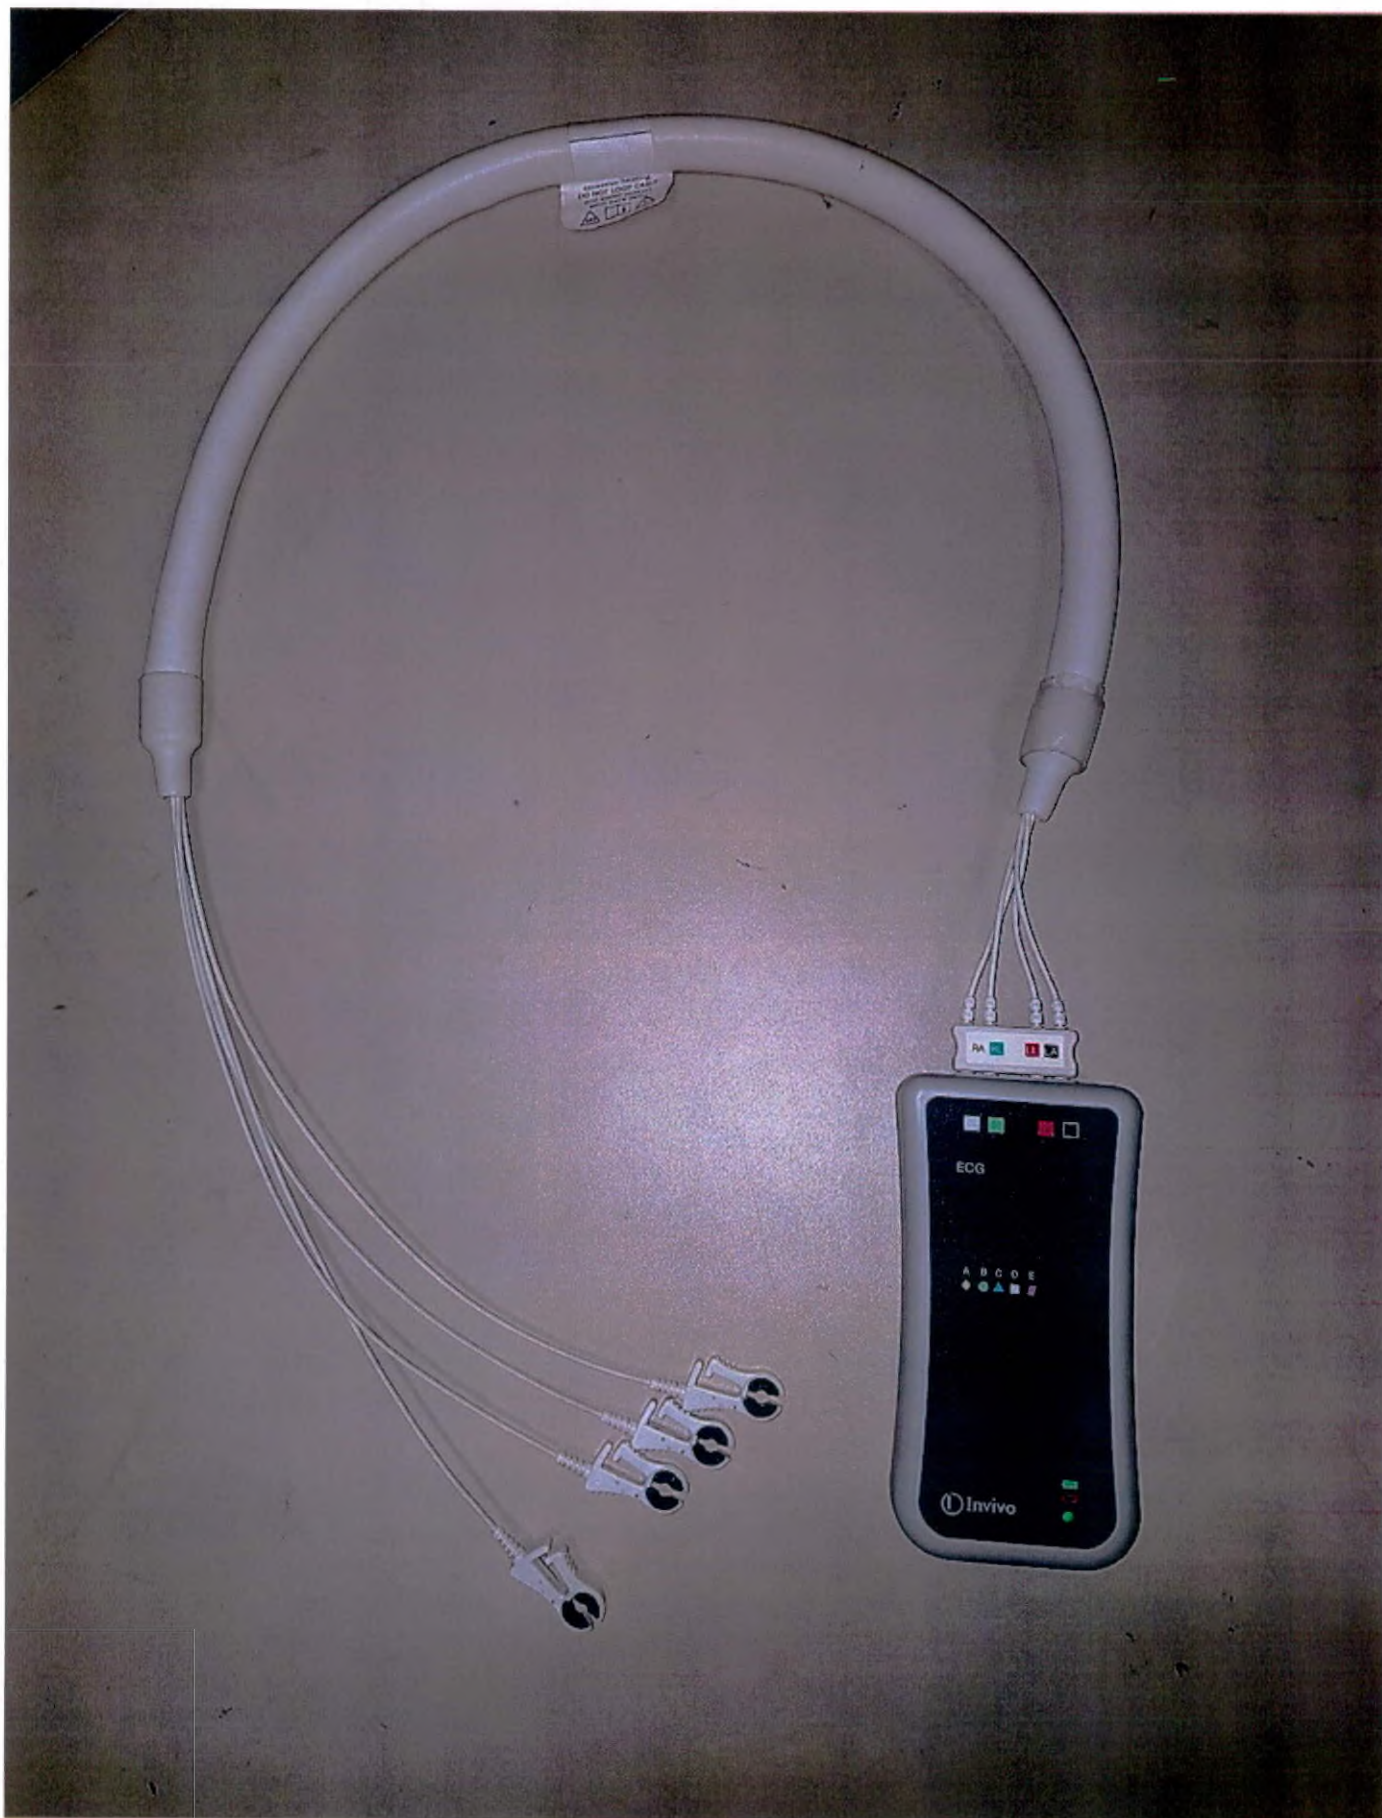


16.2. Беспроводной модуль ВКГ. Вид 1.



16.2. Беспроводной модуль ВКГ. Вид 2.

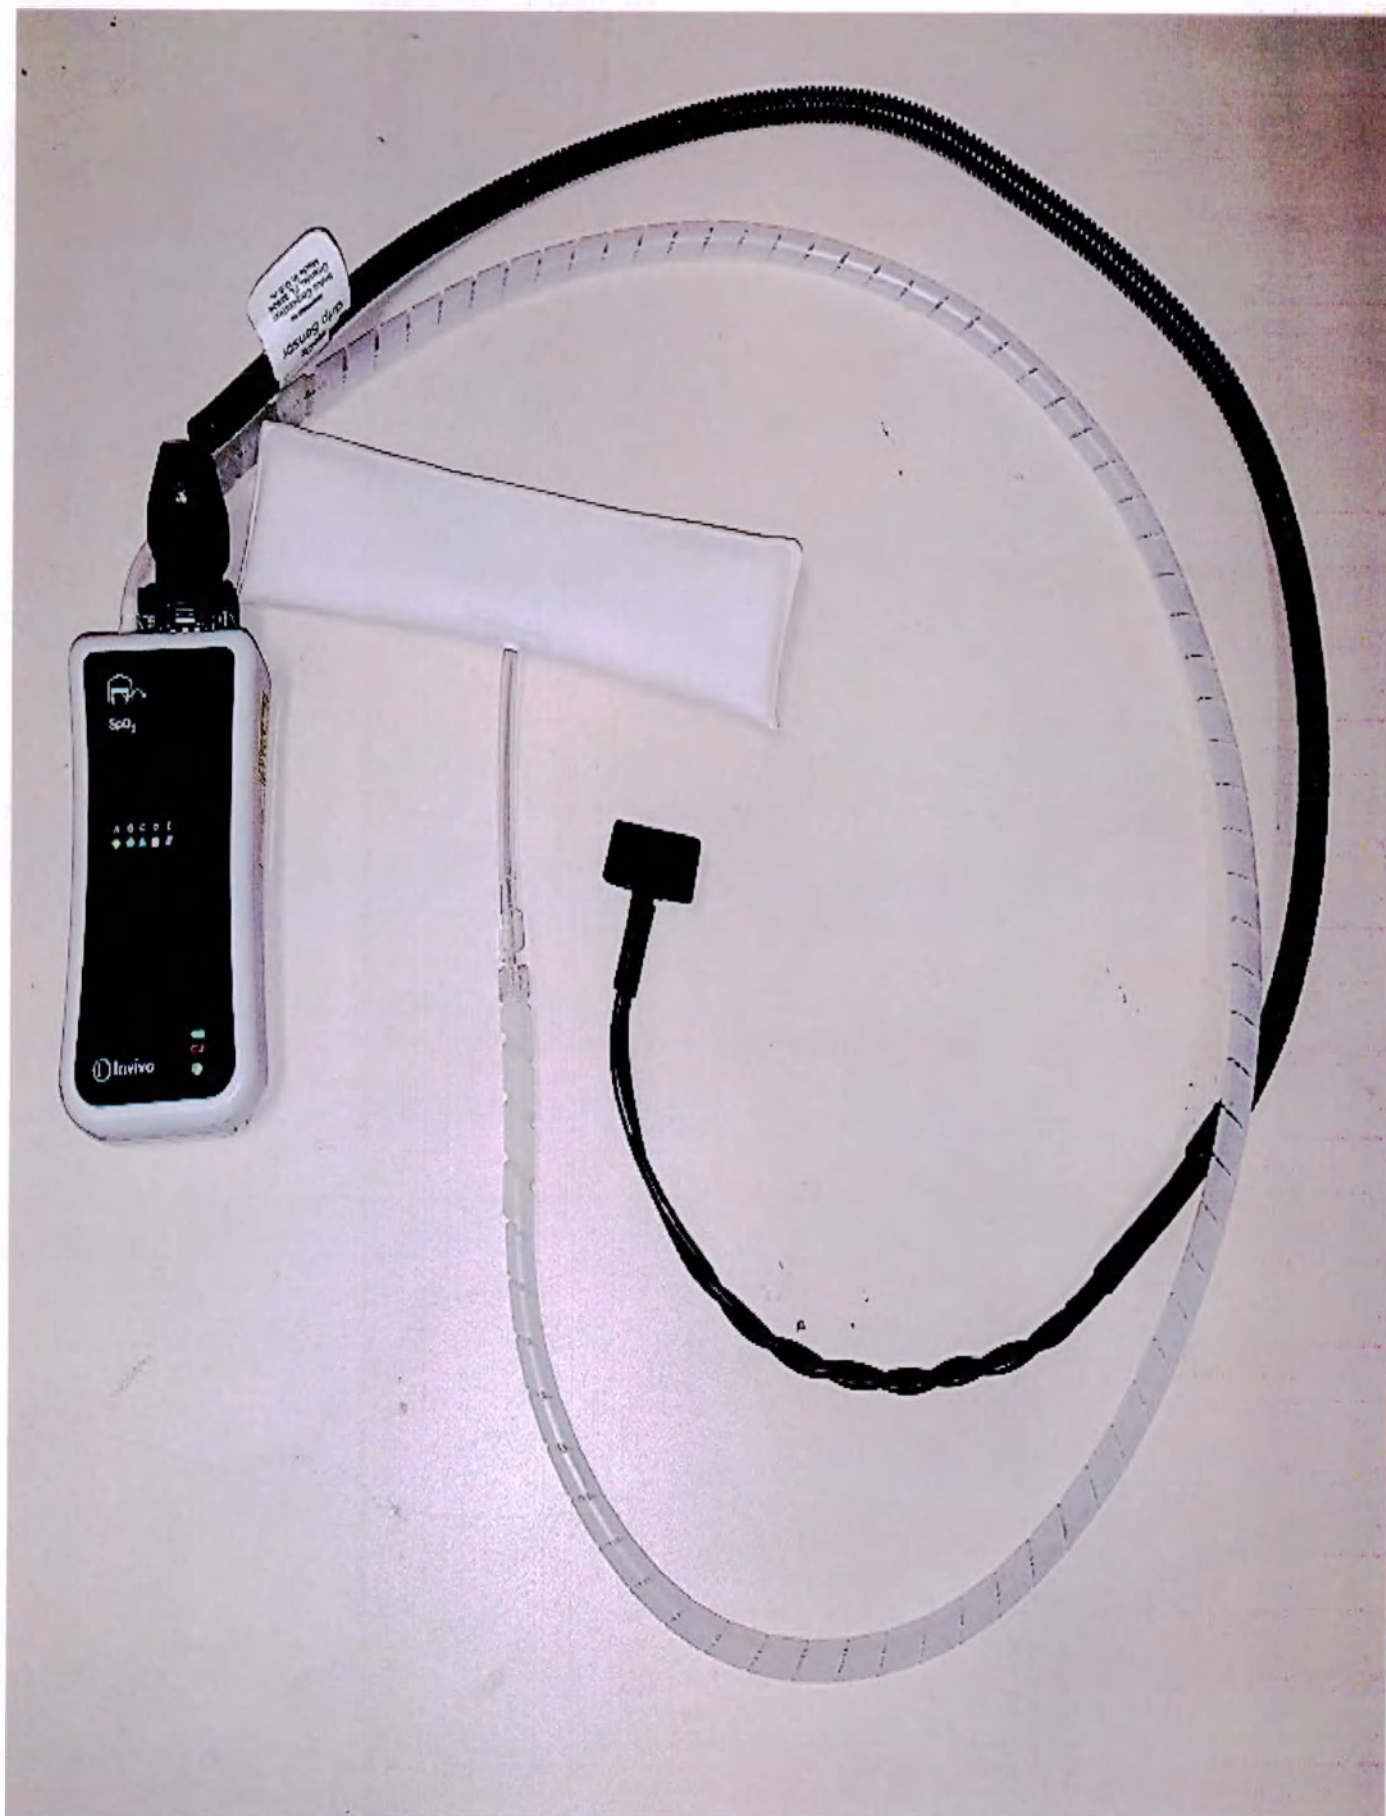

16.3. Беспроводной модуль РРУ. Вид 1.

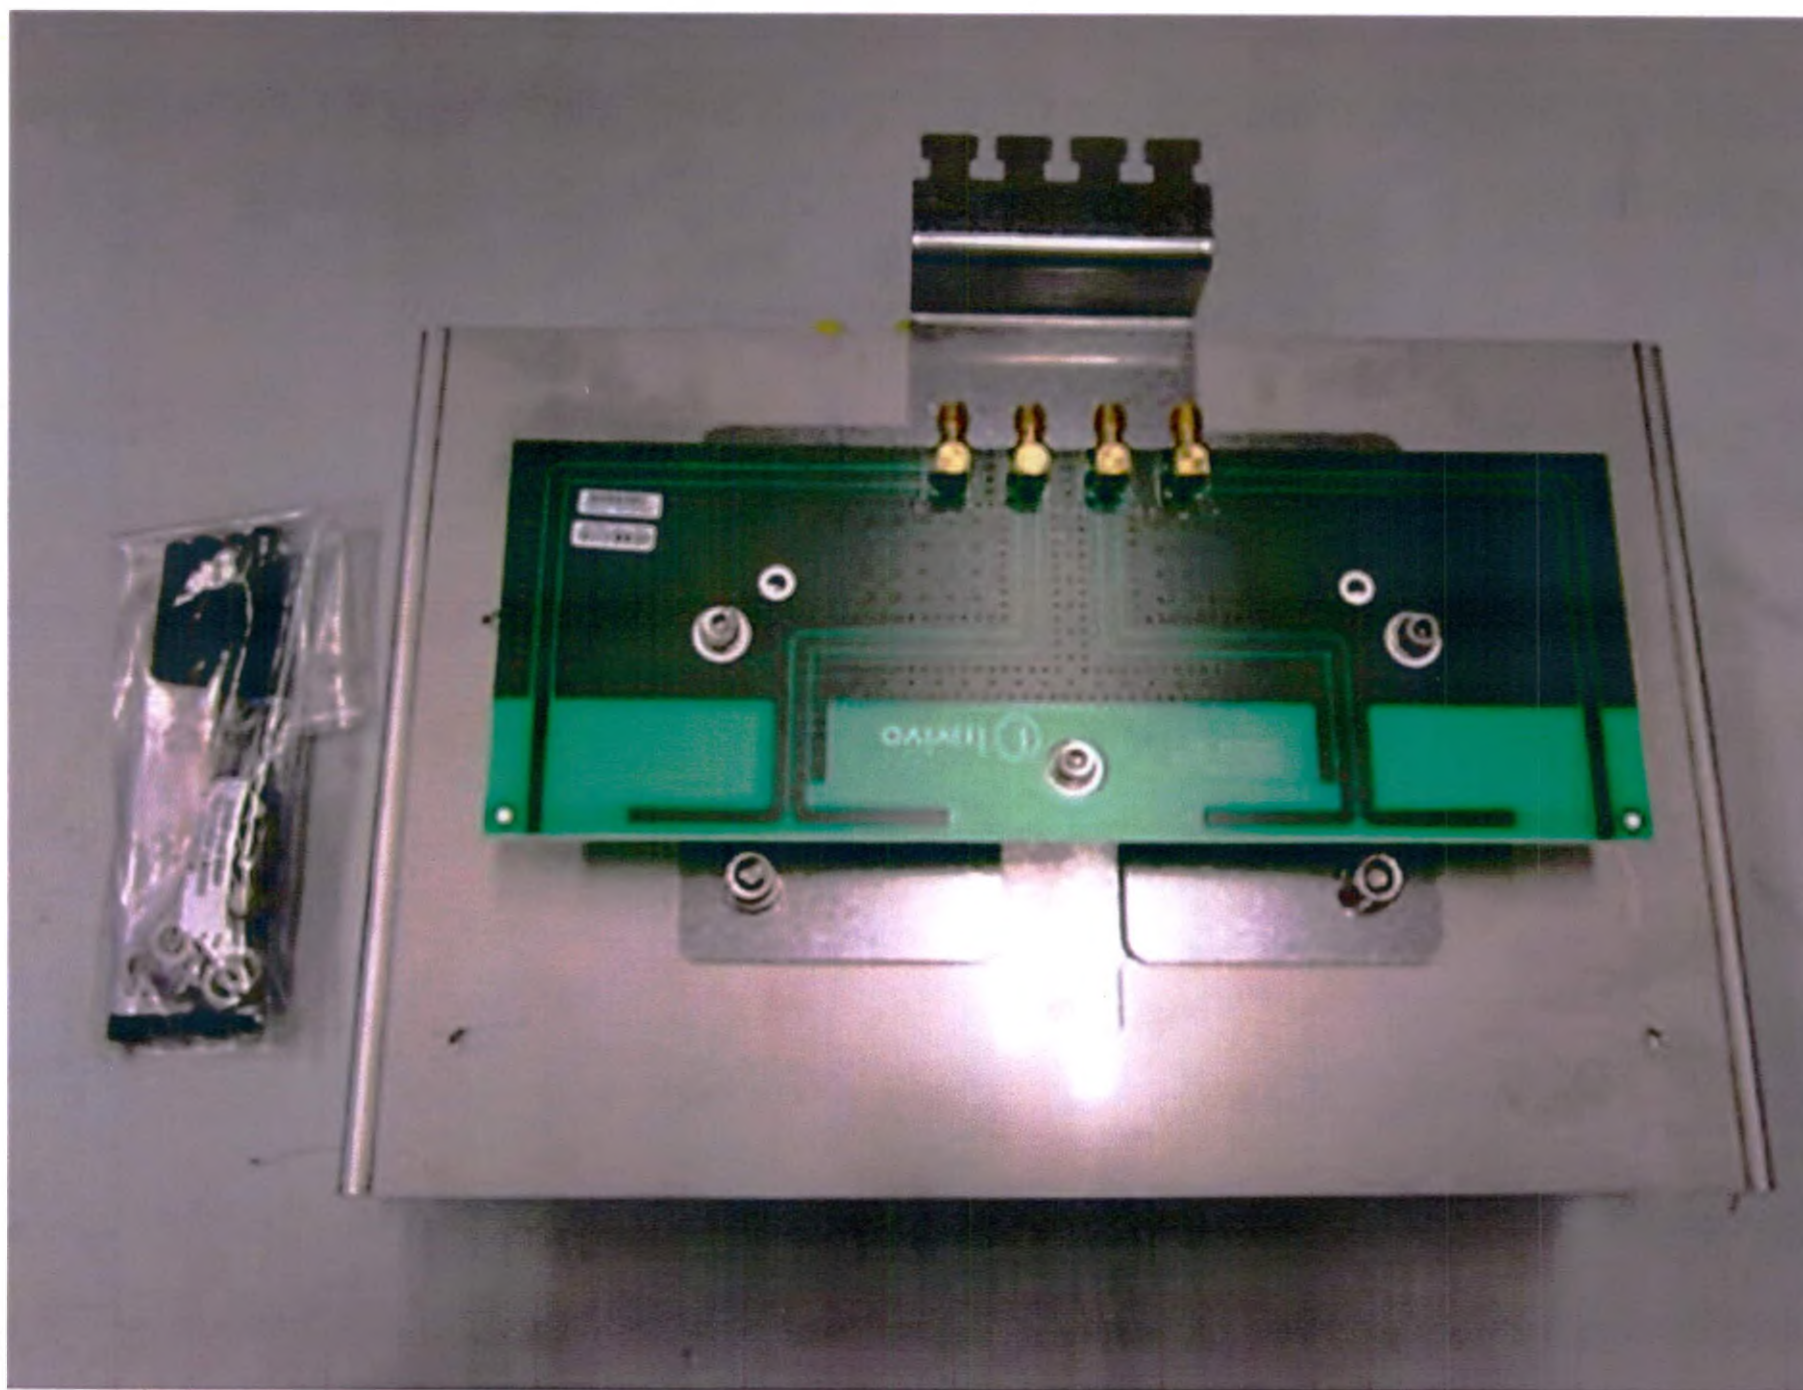


16.4. Беспроводной модуль базовой синхронизации. Вид 1.



16.4. Беспроводной модуль базовой синхронизации. Вид 2.



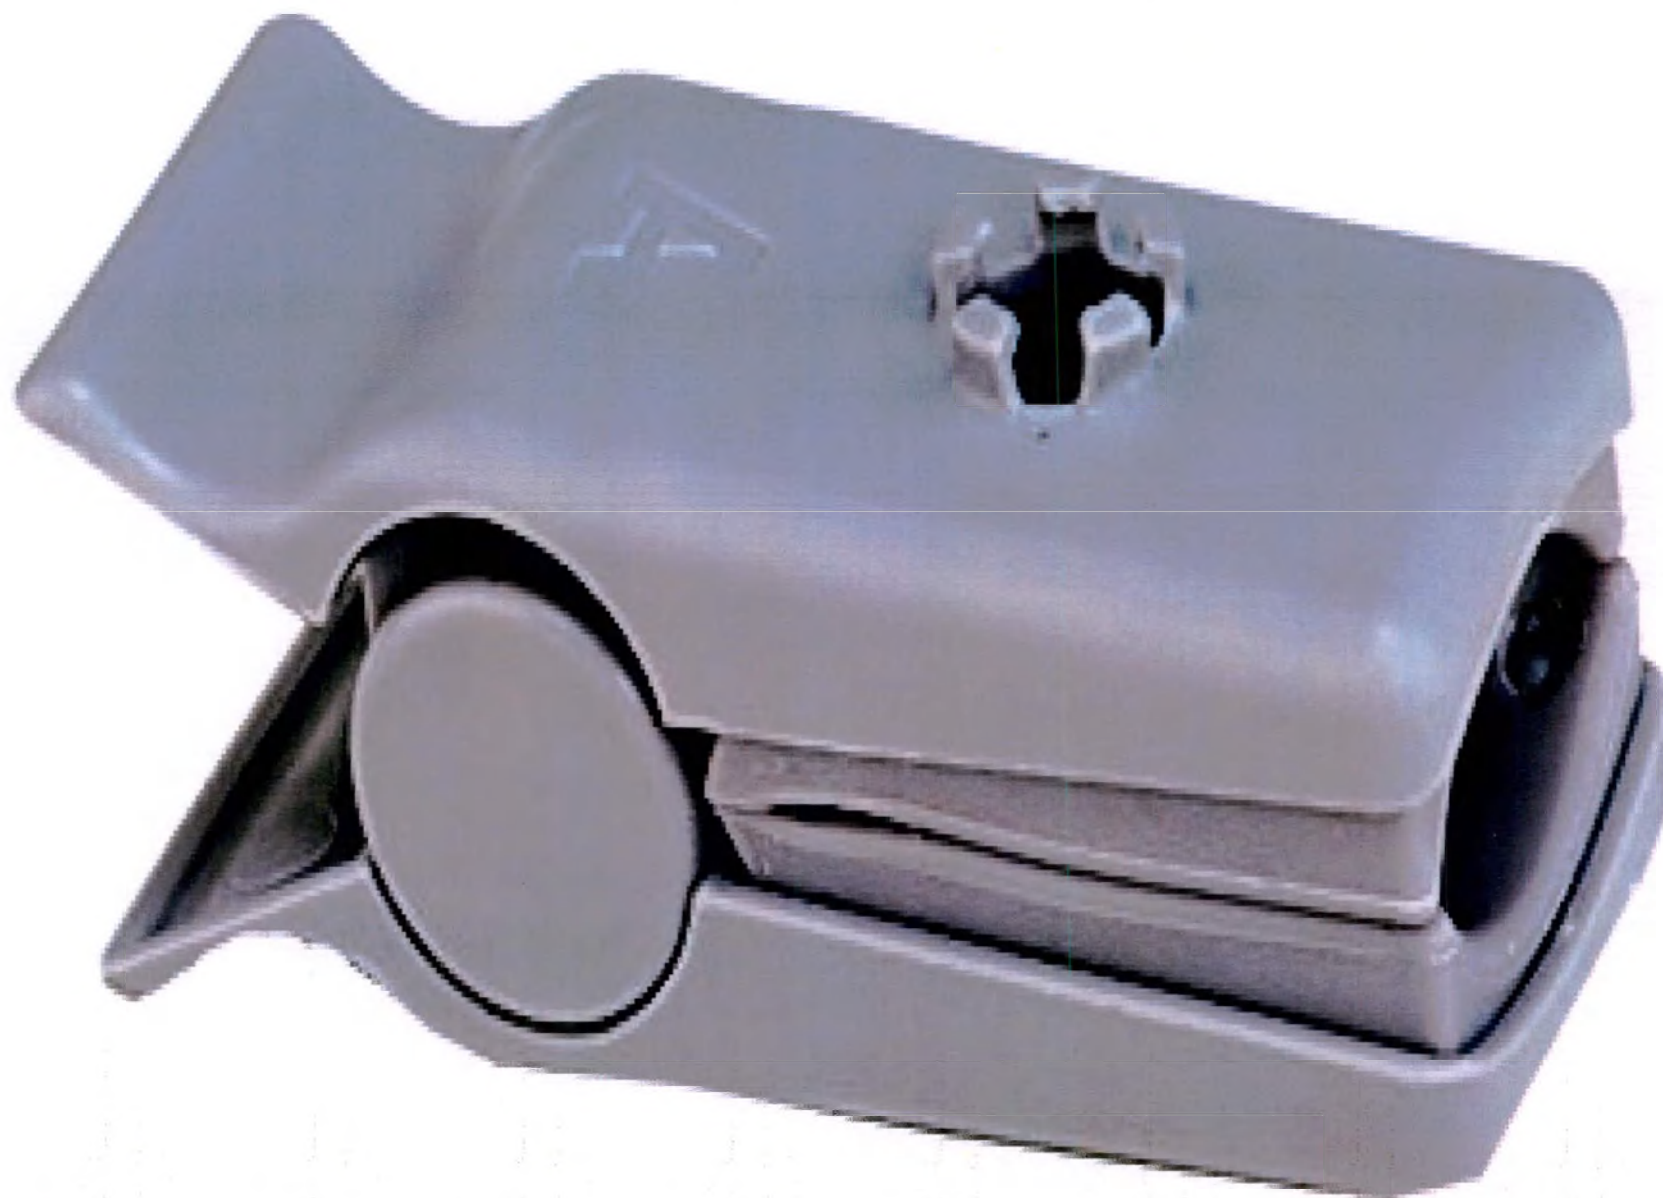





16.9. Одноразовый охватывающий зажим для датчика SPO2 для детей.



Assembled for **Made in USA** 2016-01-15
Invivo, a division of Philips Medical Systems
12151 Research Parkway, Orlando, FL 32826 USA
REF 9065 Rev R **3.7V Rechargeable Li-Polymer**

CAUTION: Do not disassemble. Do not put in fire or short circuit. Only use specified manufacturer's charger. Replace with same **REF** only.

ATTENTION: Ne pas démonter la batterie. Ne pas provoquer de court-circuit sur la batterie et ne pas la jeter au feu. Utiliser uniquement le chargeur indiqué par le fabricant. Remplacer la batterie par le même numéro de référence uniquement.

SN M-177425 1ICP5/35/61 Watt-hour rating 3.1Wh




16.12. Зарядное устройство.




17. Система сбора и управления данными DACC.



18. Кнопка экстренной остановки магнита.

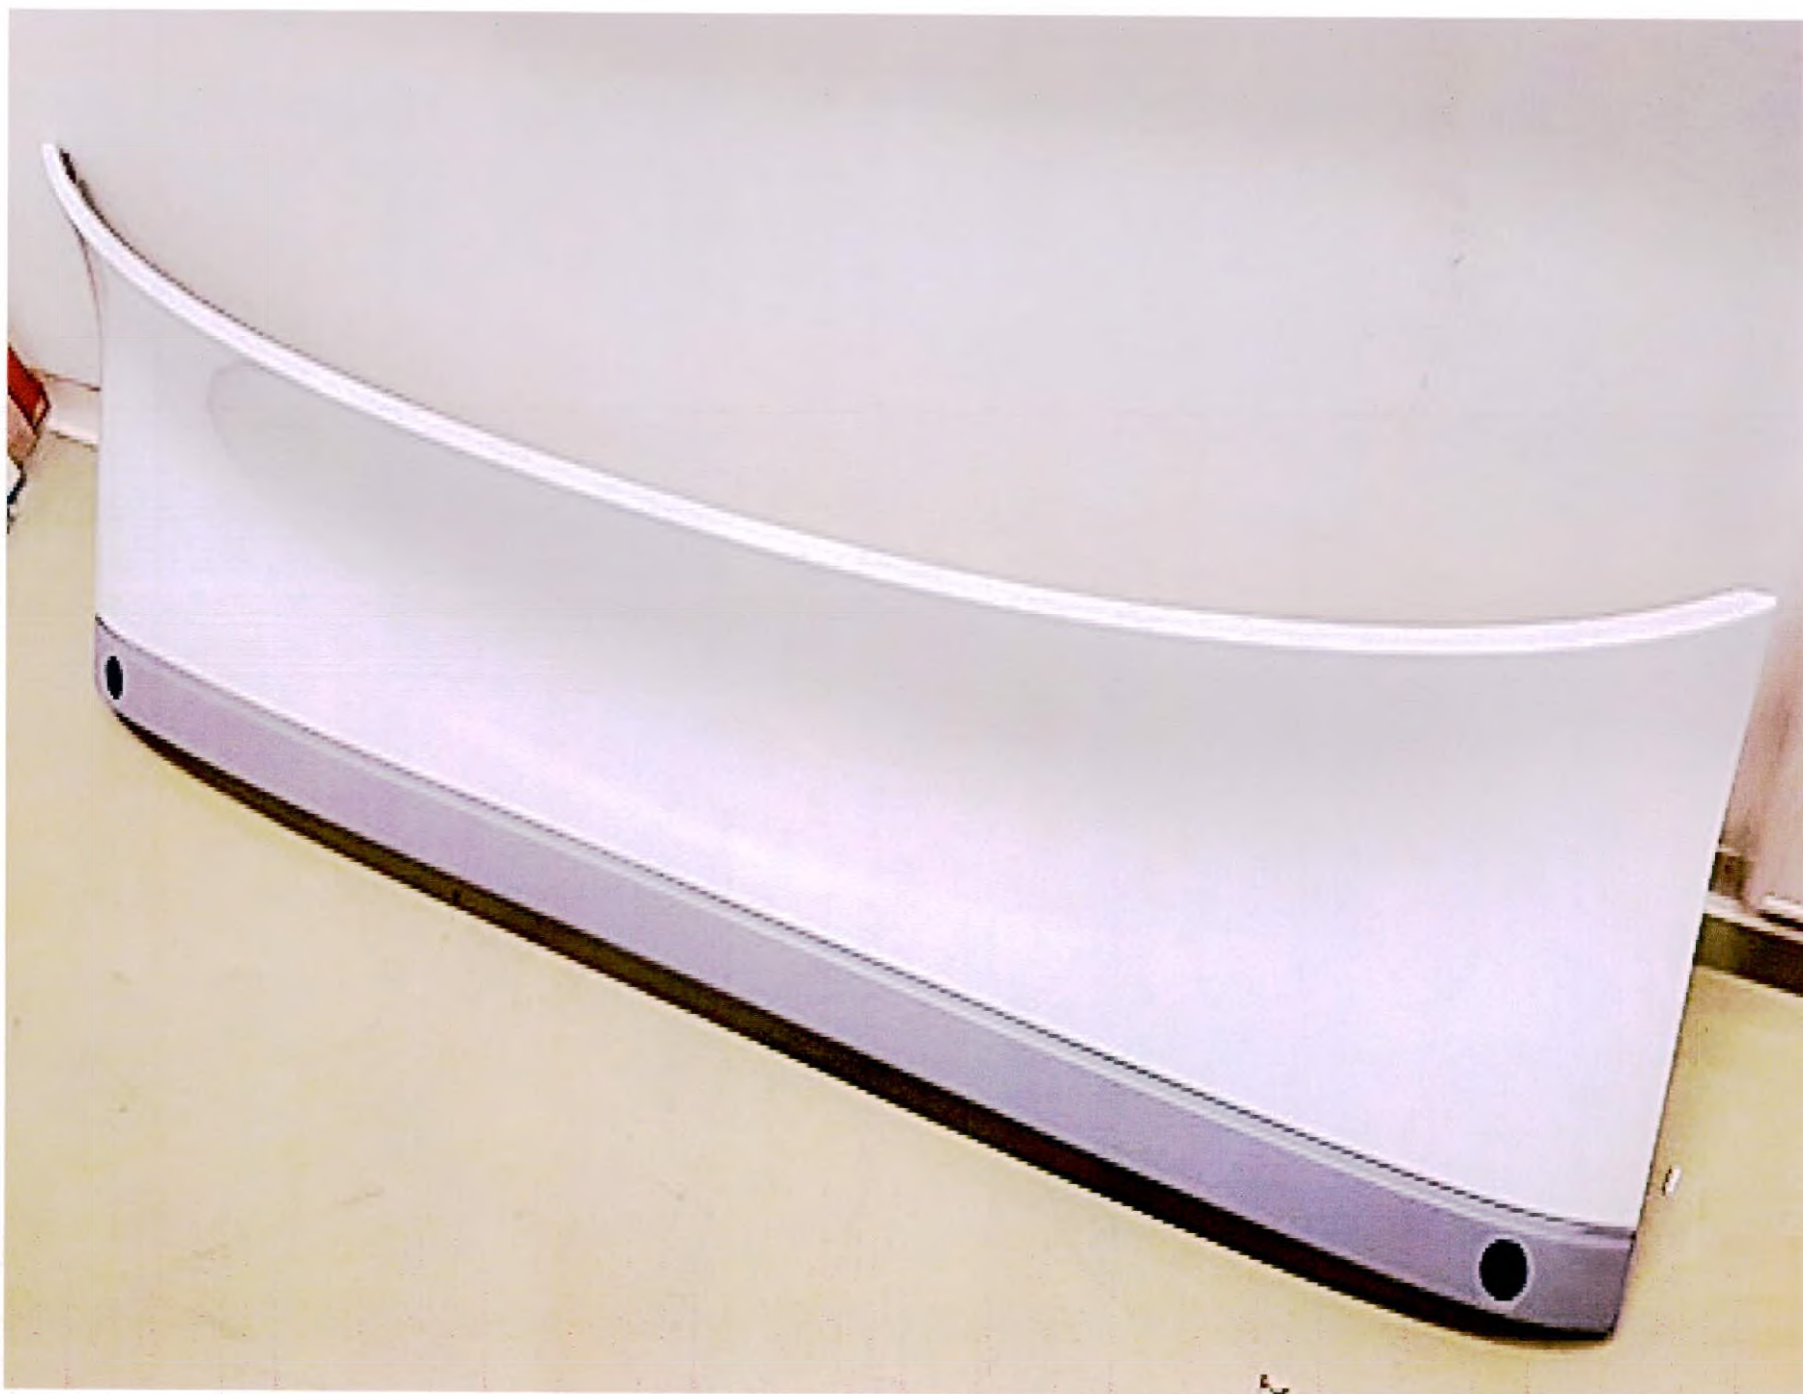

19. Кожух магнита. Правая сторона, низ.

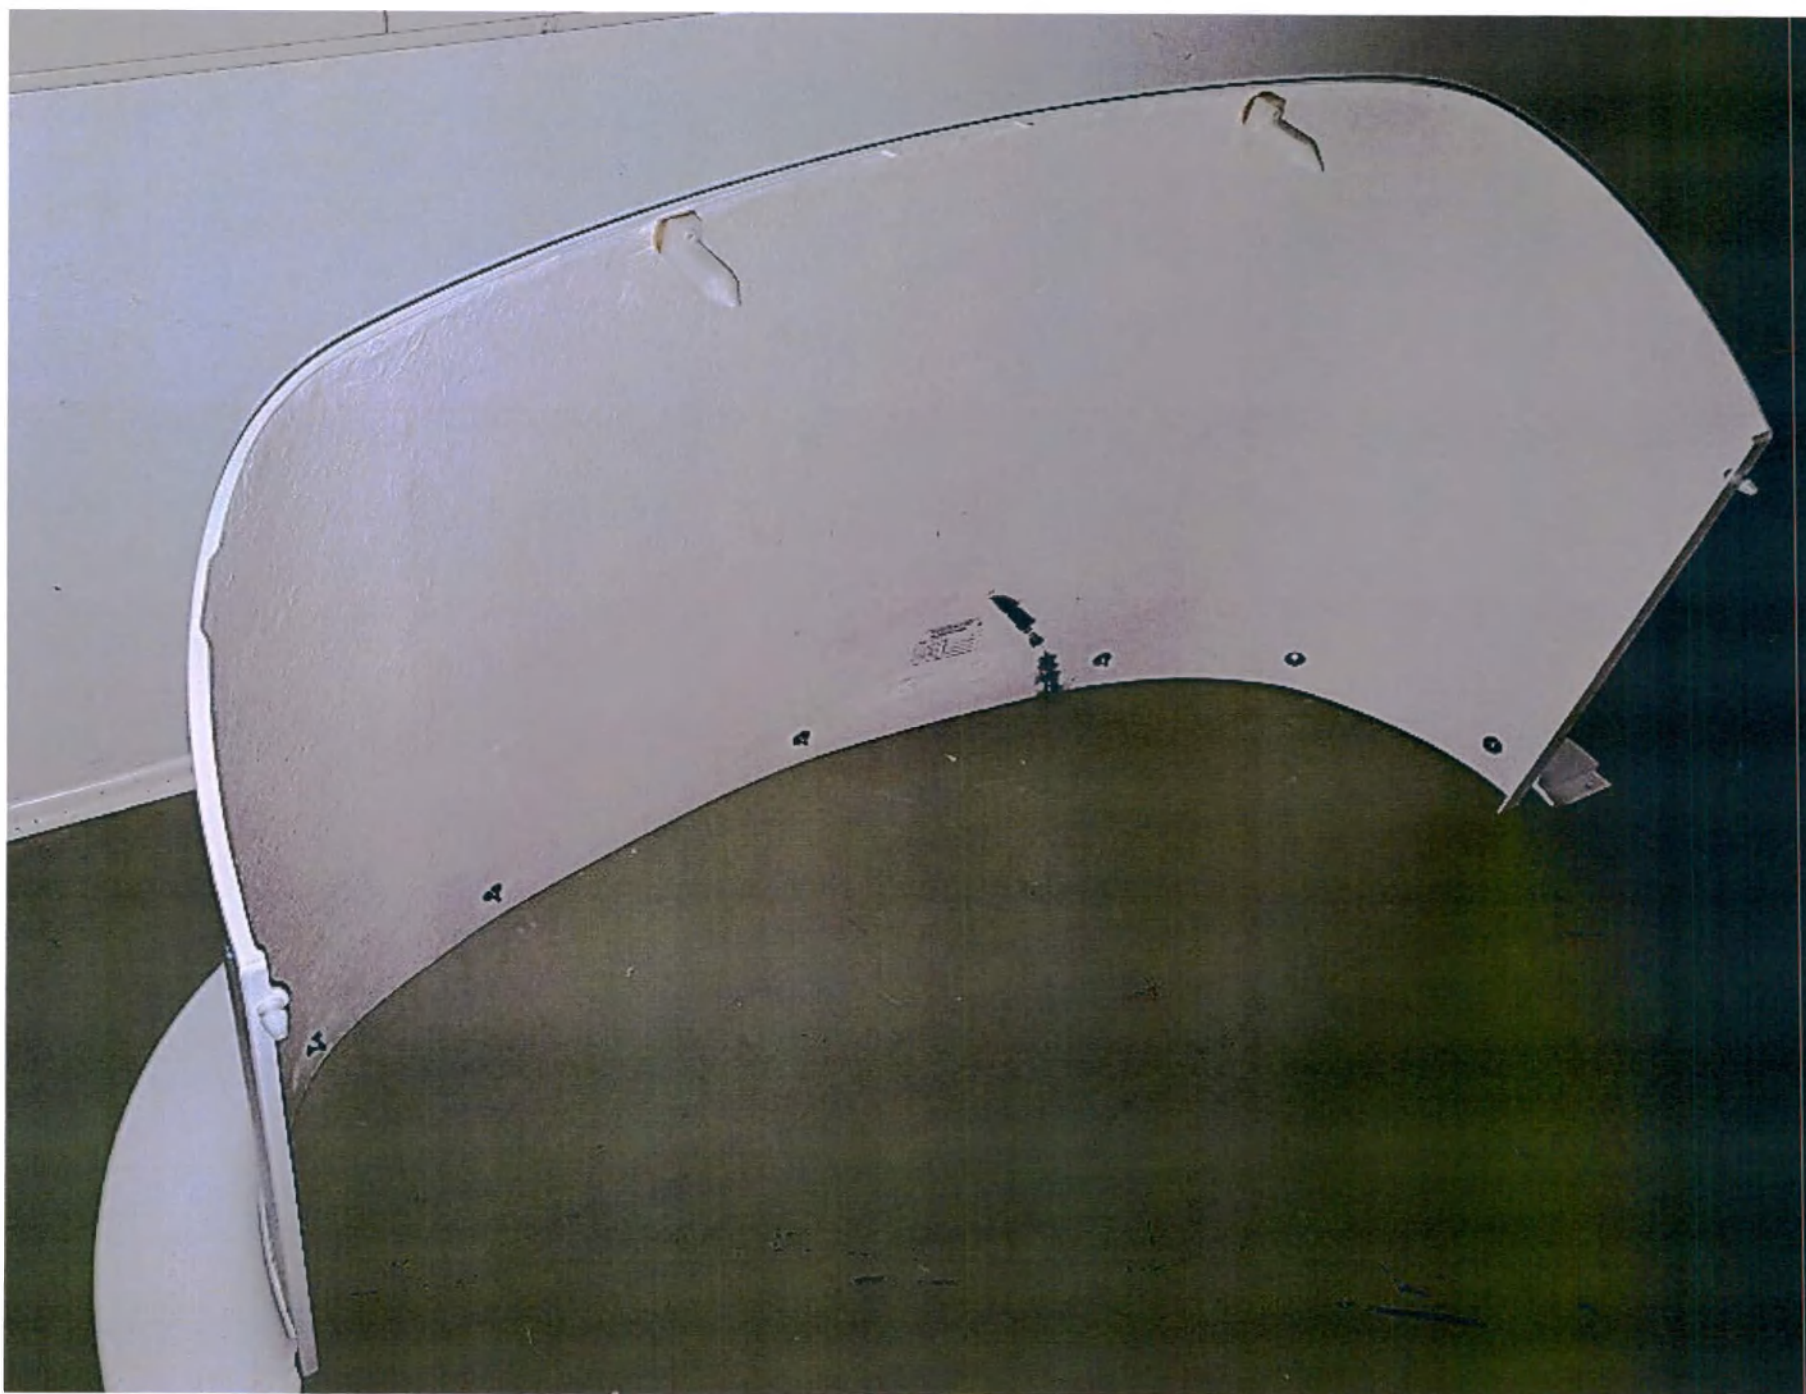




20. Системный фильтрующий блок.




21. Система охлаждения с нулевым выкипанием гелия.




22. Система вытяжки гелия.

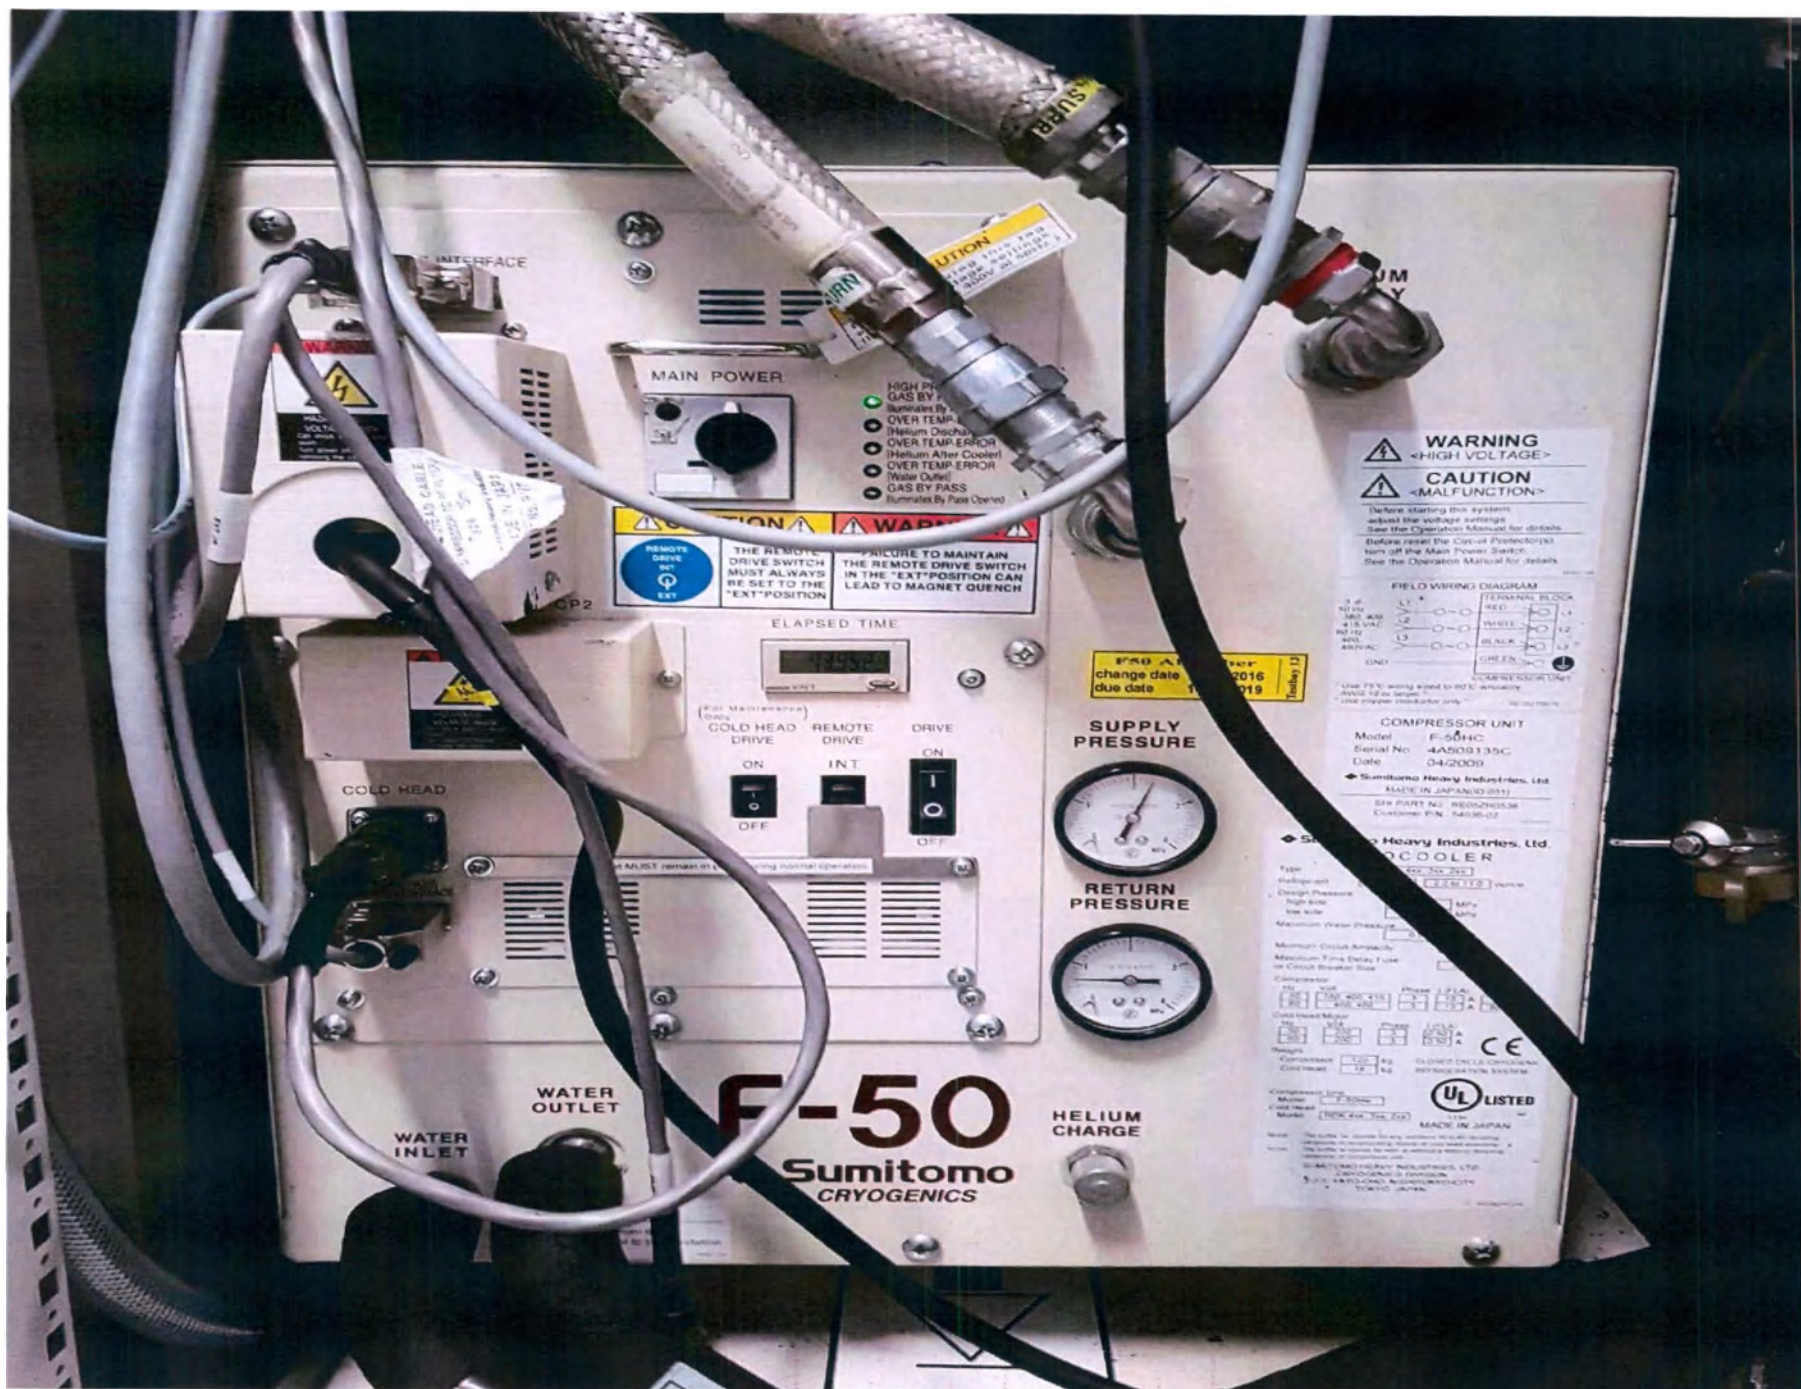


23. Низкотемпературный компрессор.

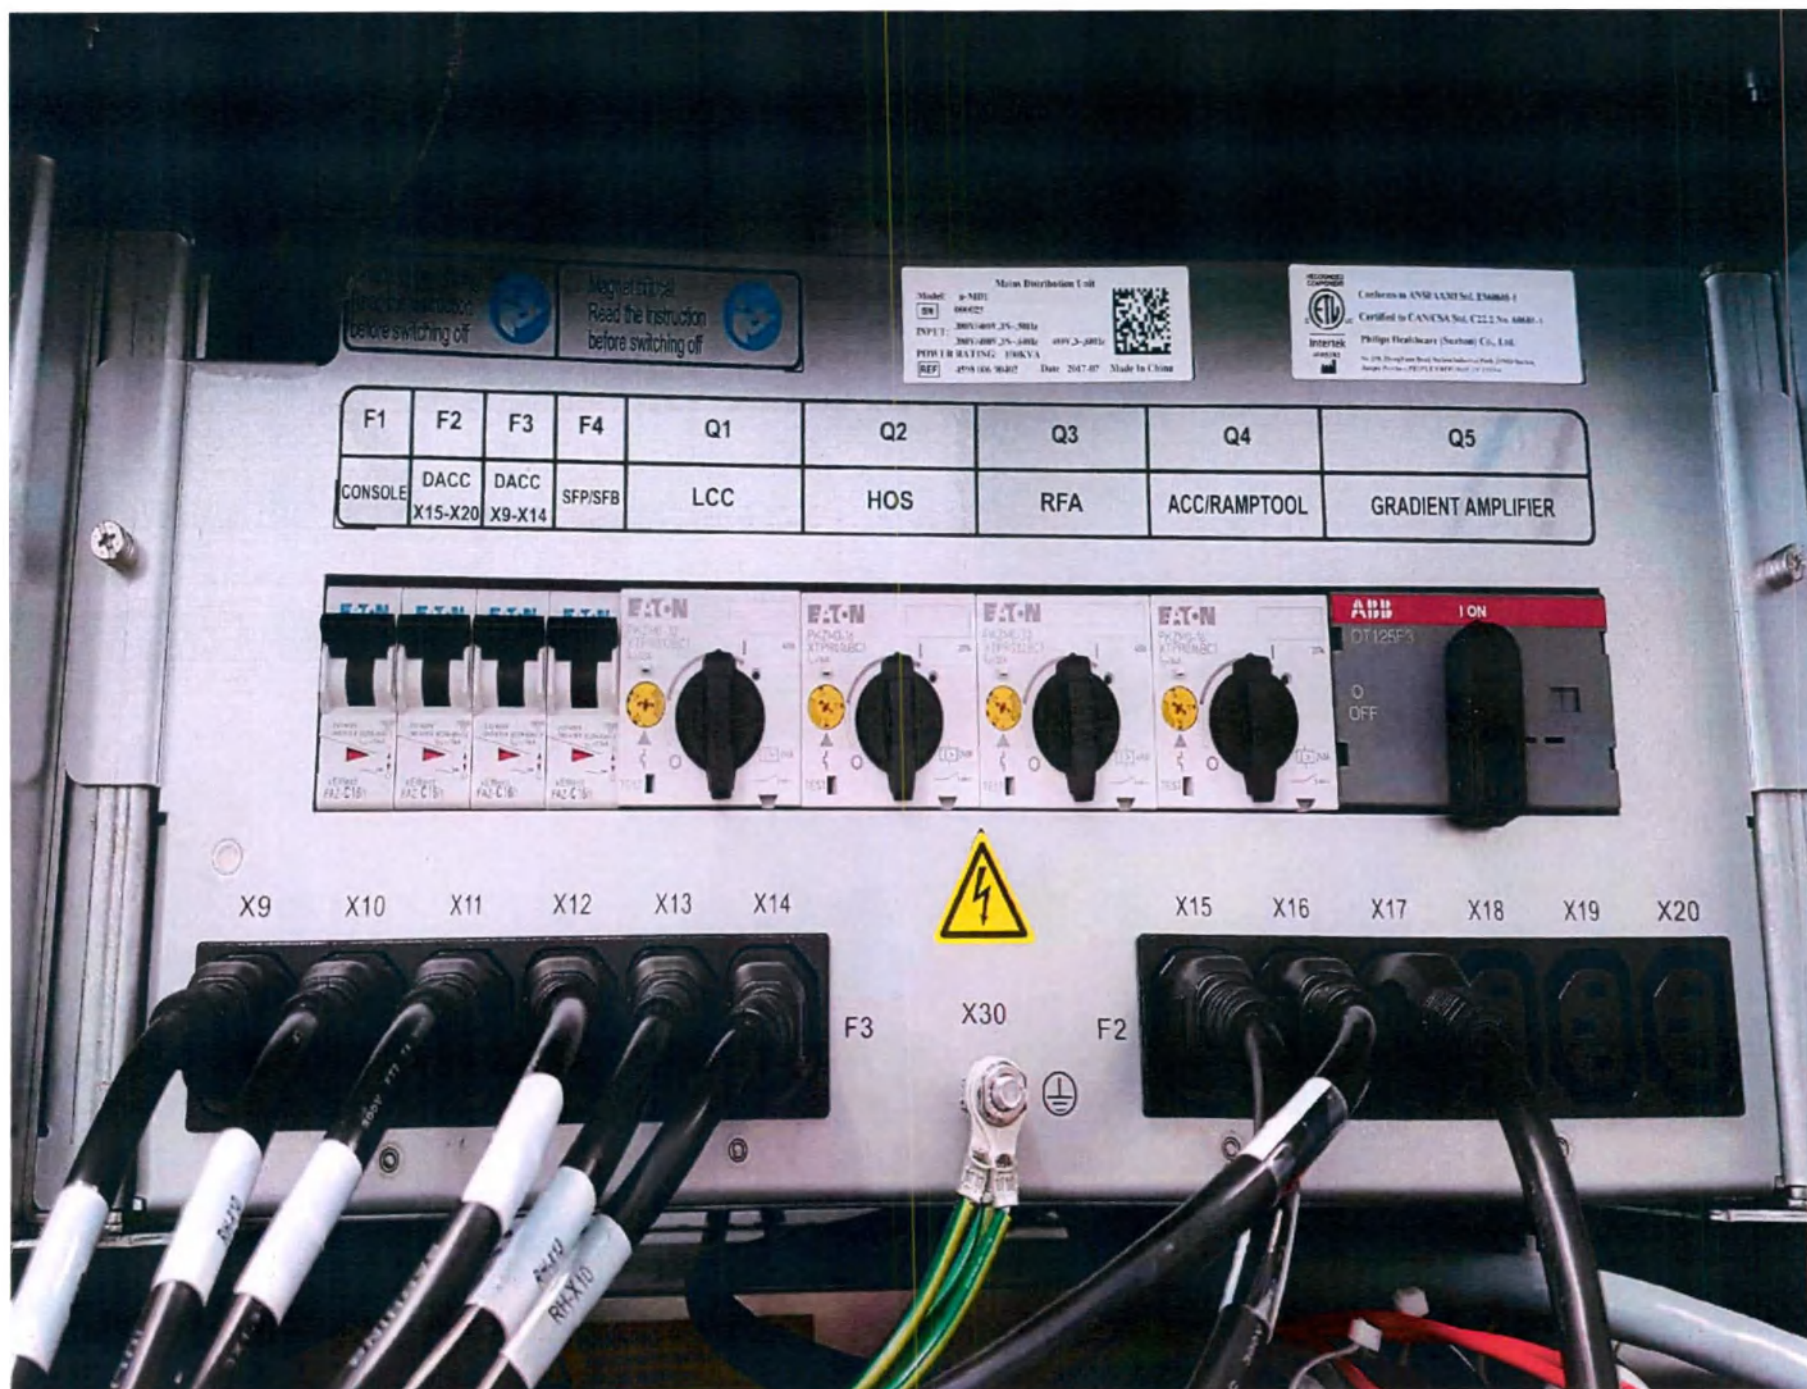

24. Универсальный электрораспределительный щит uMDU.

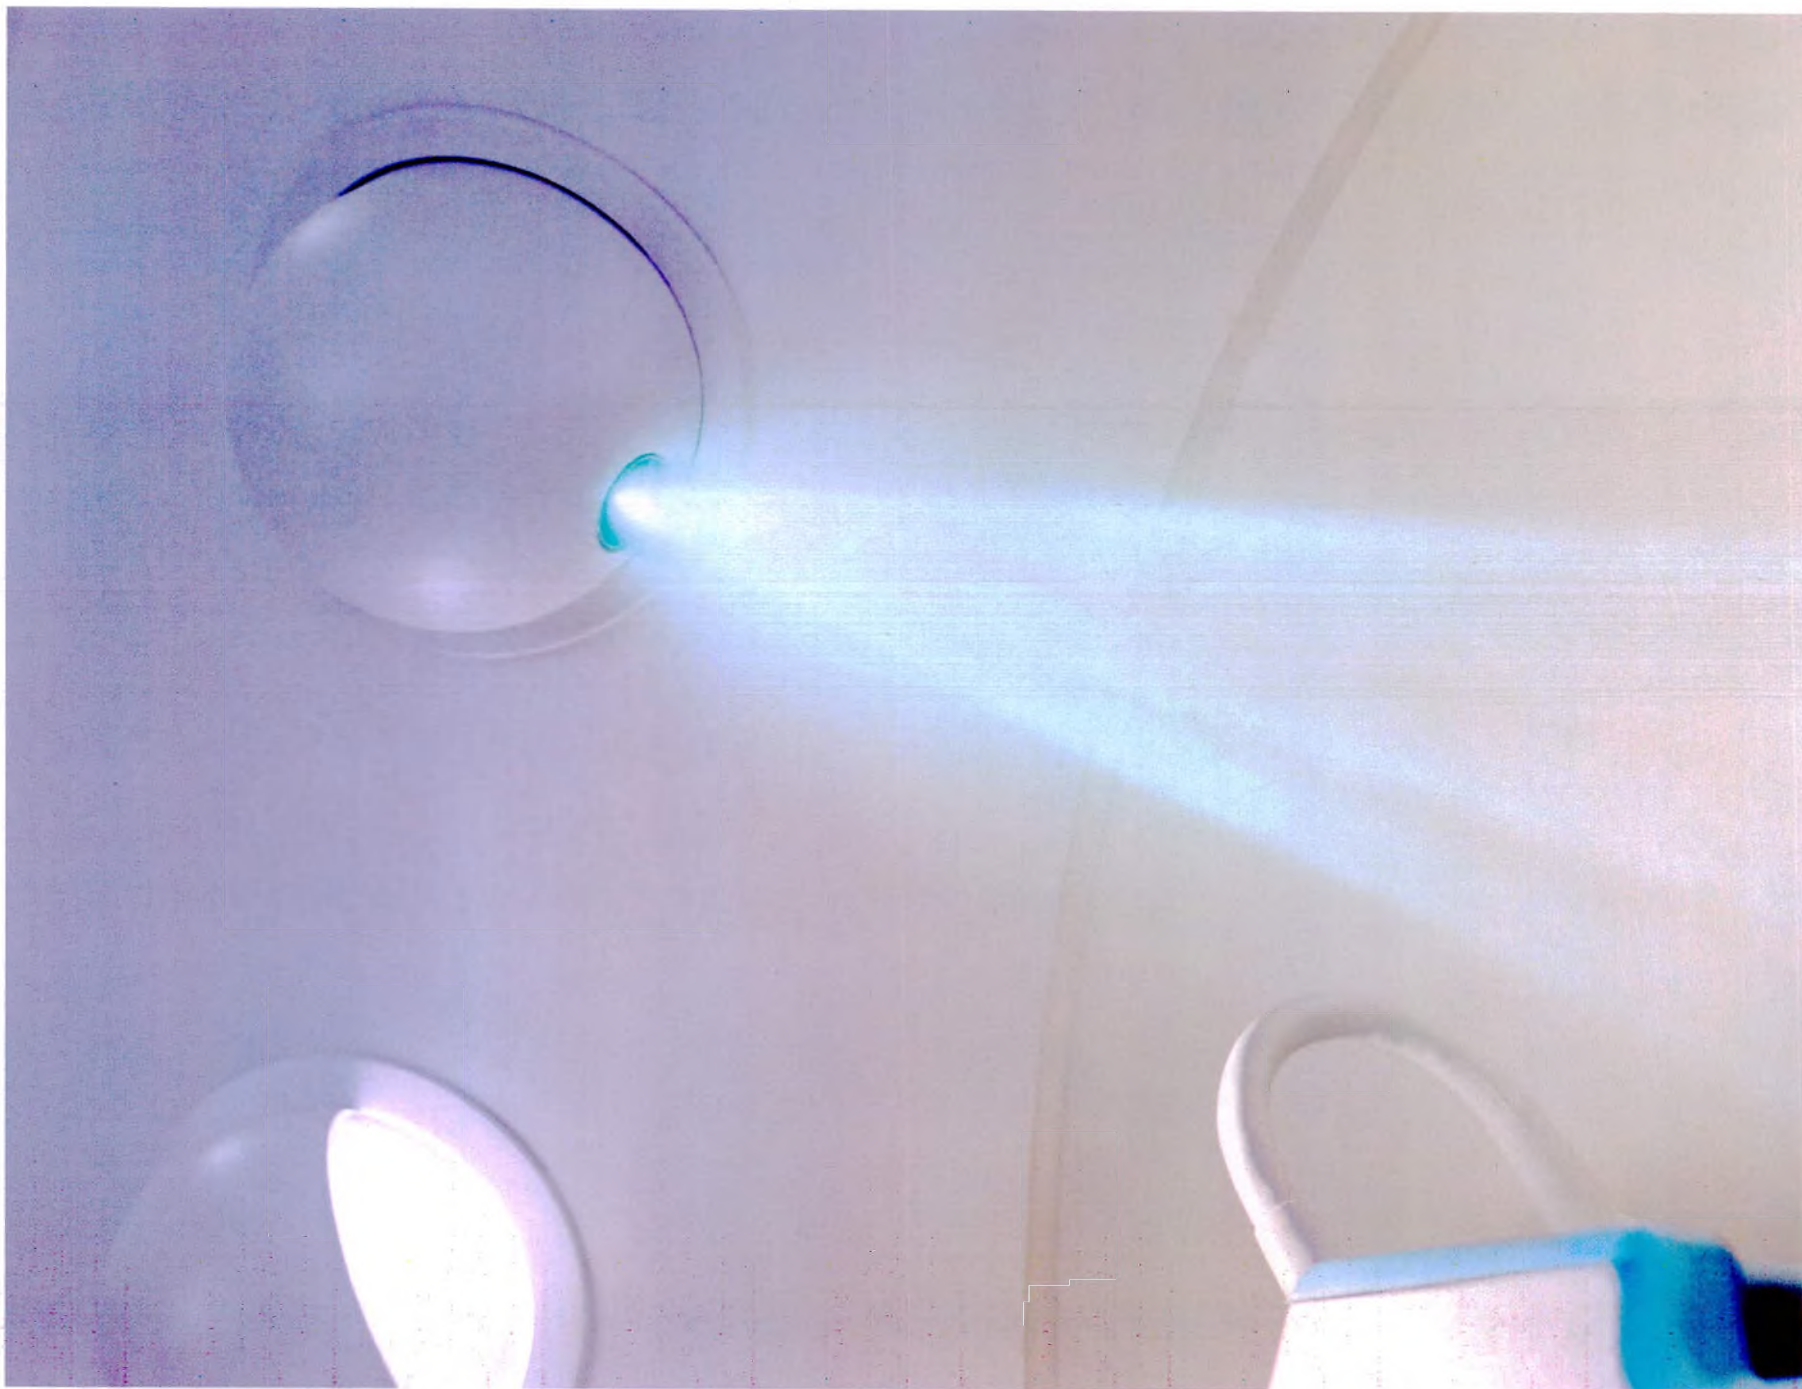


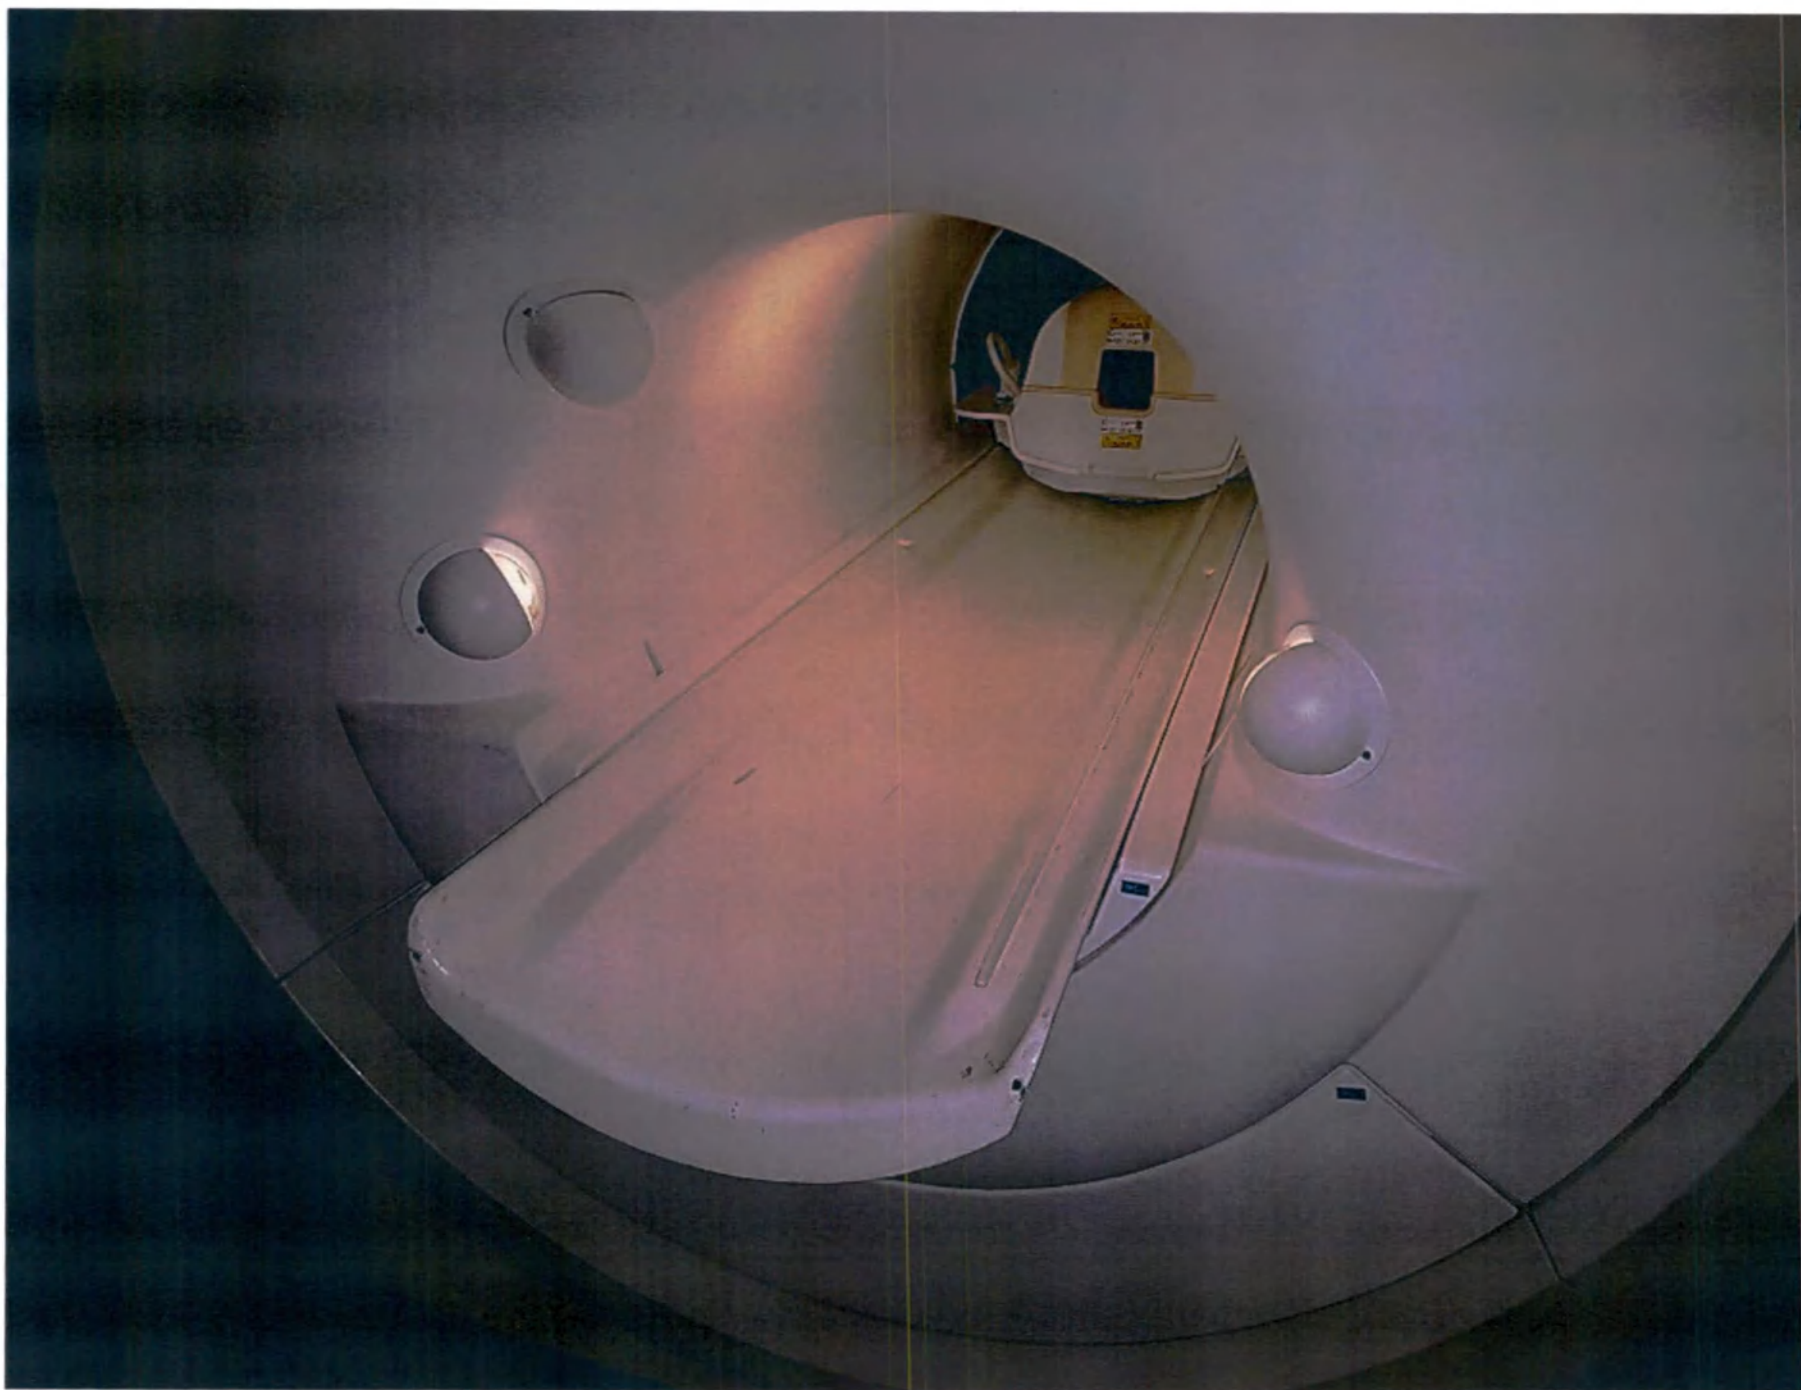

25. Система VitalEye. Вид 2.



26. Кабель питания.

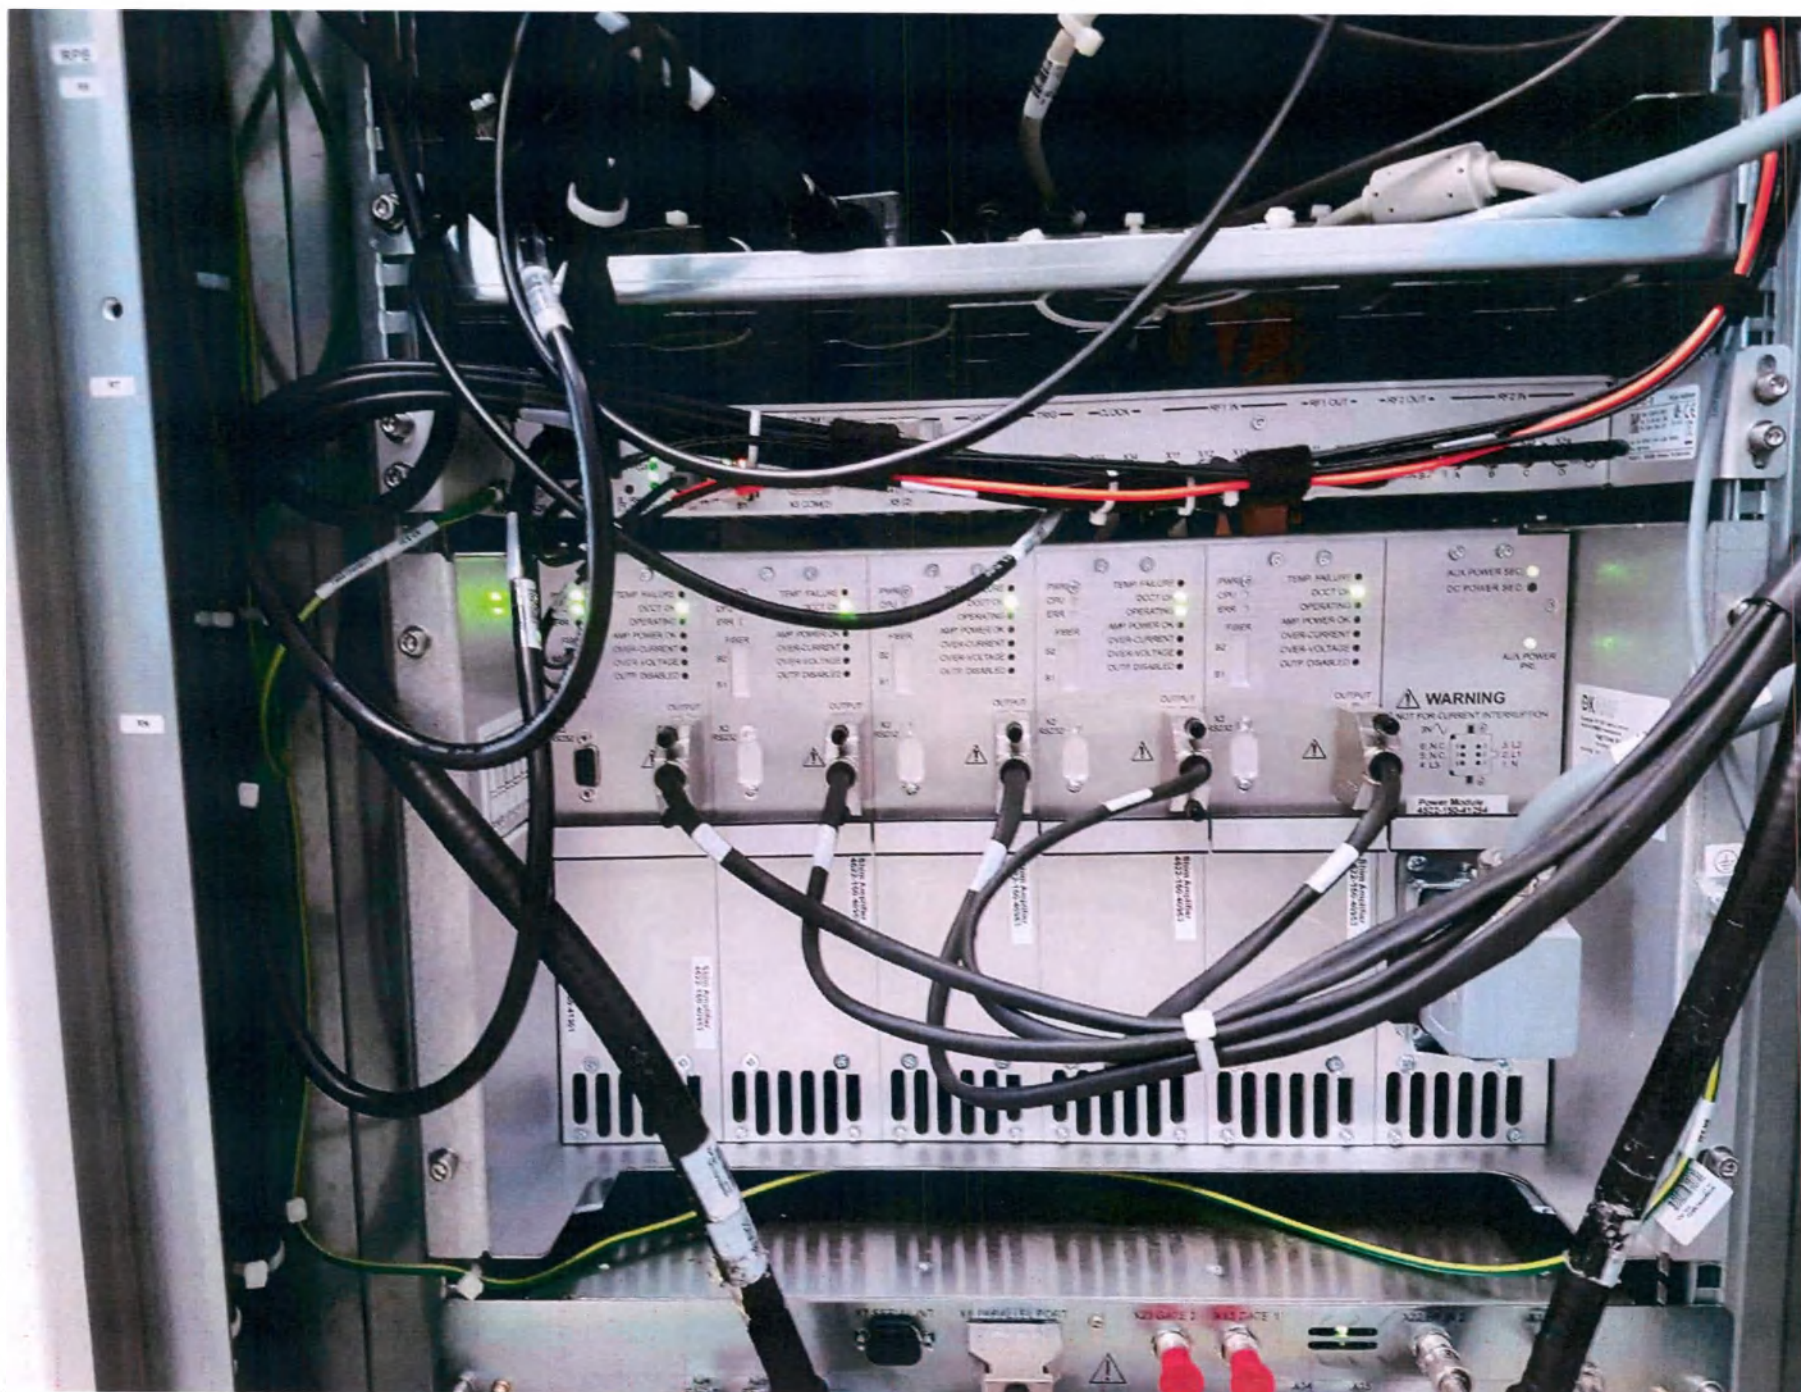

27. Кабель соединительный.



Руководство по
эксплуатации

Русский

Release 11.1

Ingenia Elition

3000 091 81453

PHILIPS

28. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных, и/или виртуальных носителях.





English (United States)

IntelliSpace Portal

Image and Information Management Software
Version 12.1

LOT 12.1.2 REF 459801635933

Rx only Quantity 1

@ 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights are reserved. Reproduction or transmission in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. Copyrights and all other proprietary rights in any software and related documentation ("Software") made available to you rest exclusively with Philips or its licensors. No title or ownership in the Software is conferred to you. Use of the Software is subject to the end user license conditions as are available on request. To the maximum extent permitted by law, you shall not decompile and/or reverse engineer the software or any part thereof. Build: 12.1.2.11402



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands



eIFU



2021-06-16



0197



(01)00884838093621
(11)210616 (10)12.1.2



1. Кнопка вызова медсестры.



2. Наушники. Активный вариант.



3. Наушники. Пассивный вариант.



4. Устройство Caddy для катушек.




5. Шкаф для хранения катушек.




6. Ящик для фантомов.

7. Фантомы:

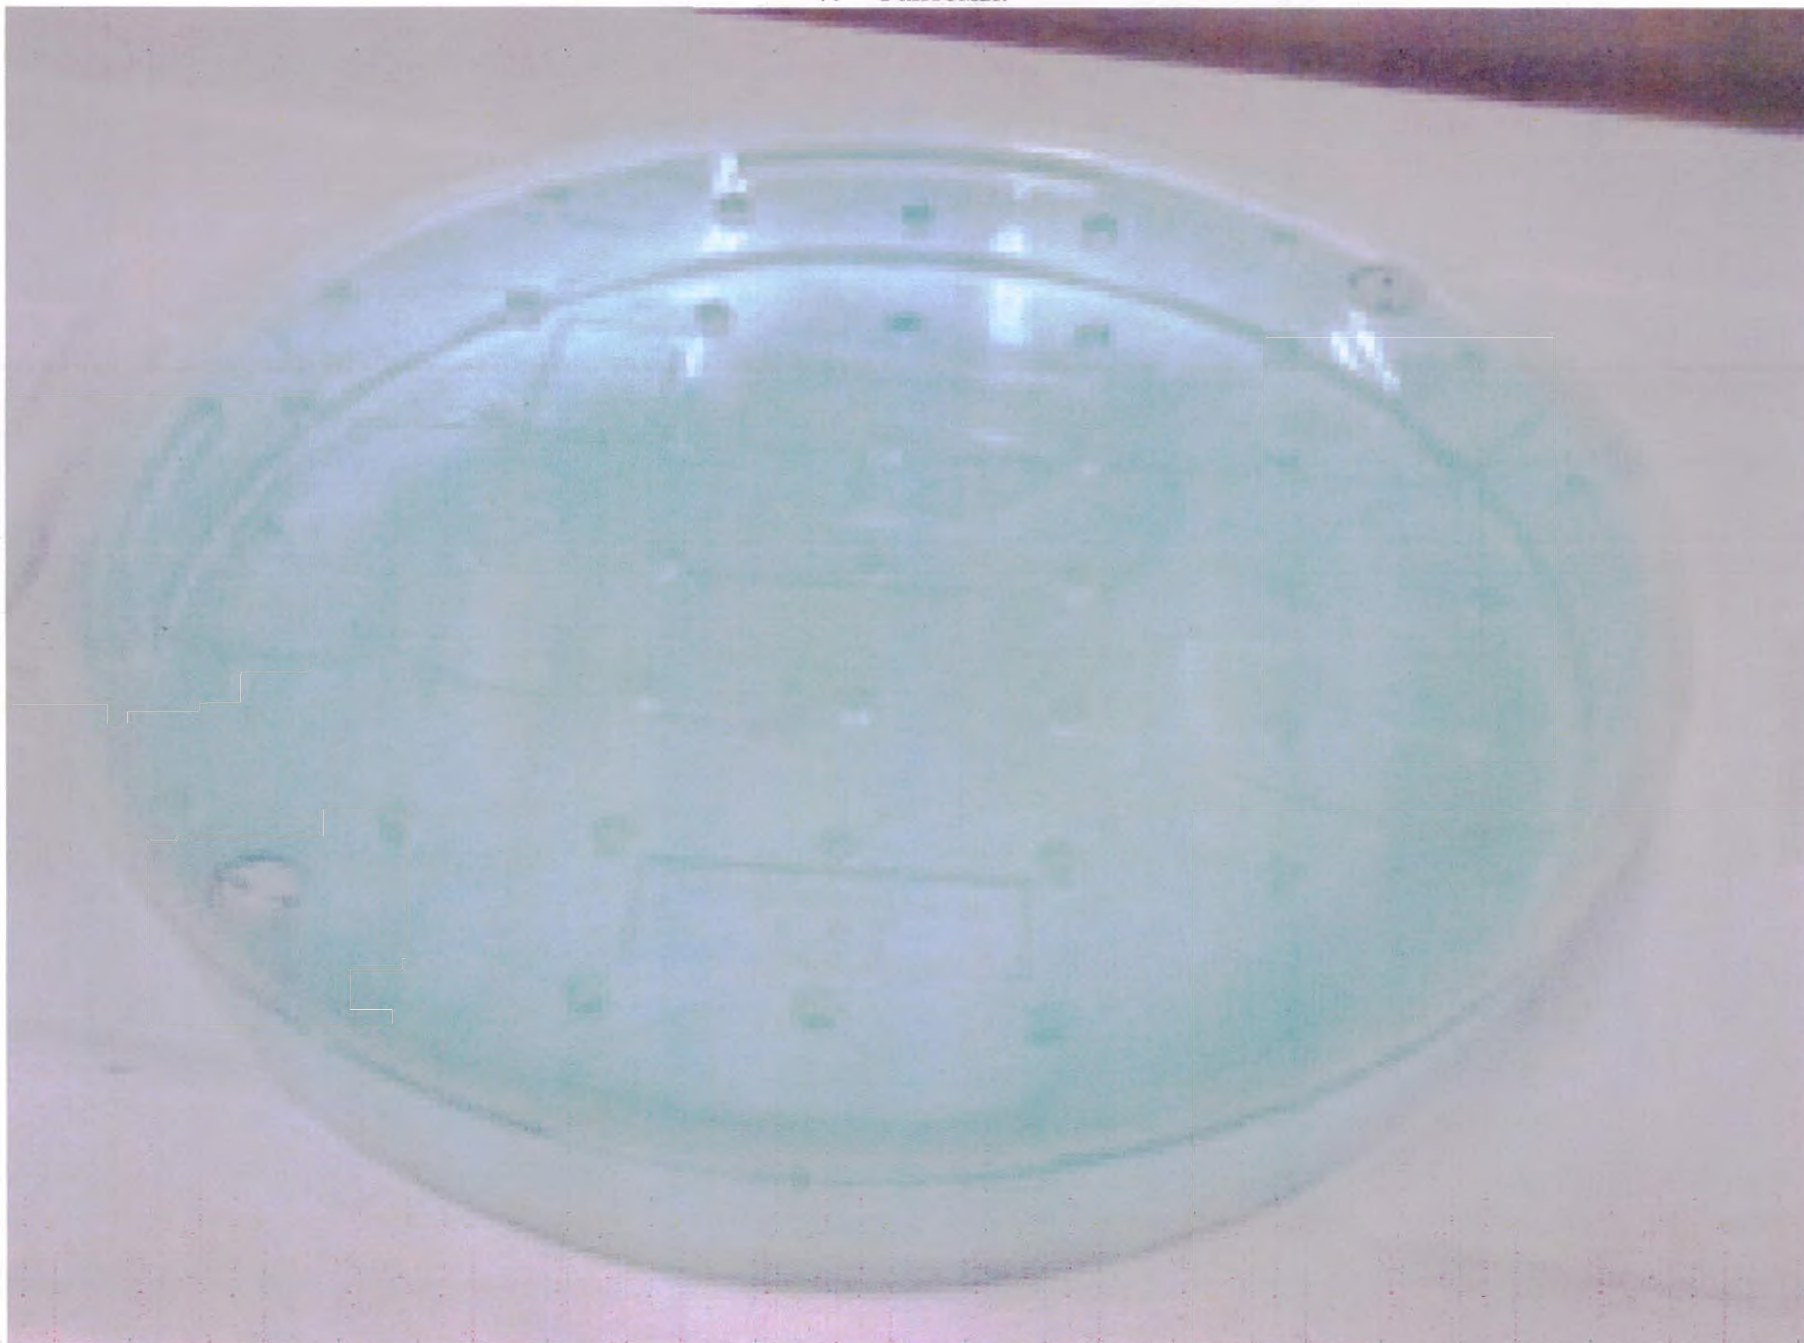


7.1 Фантом тела (400 мм).

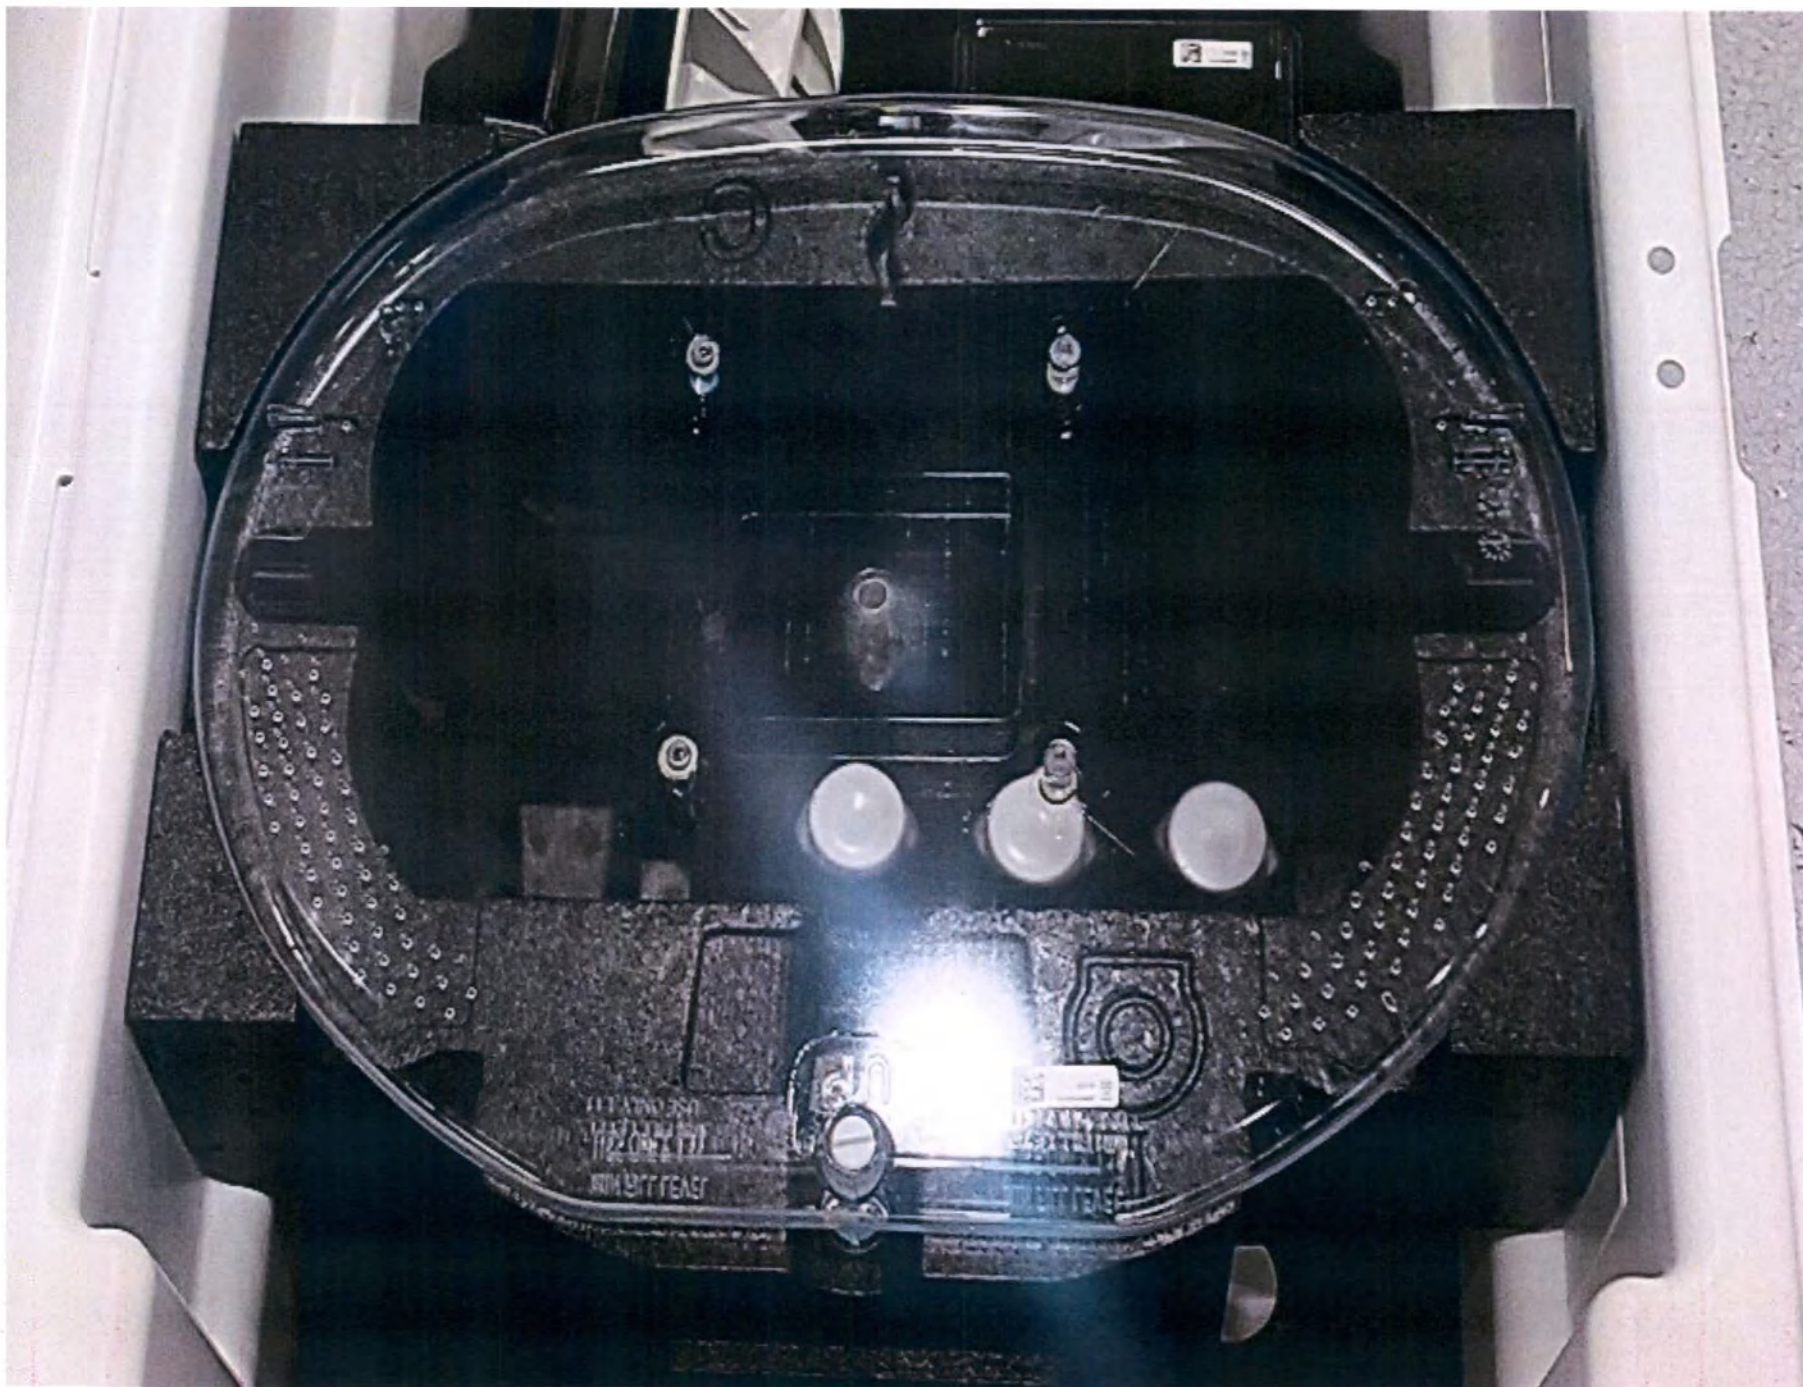




7.3 Фантом головы (200 мм).

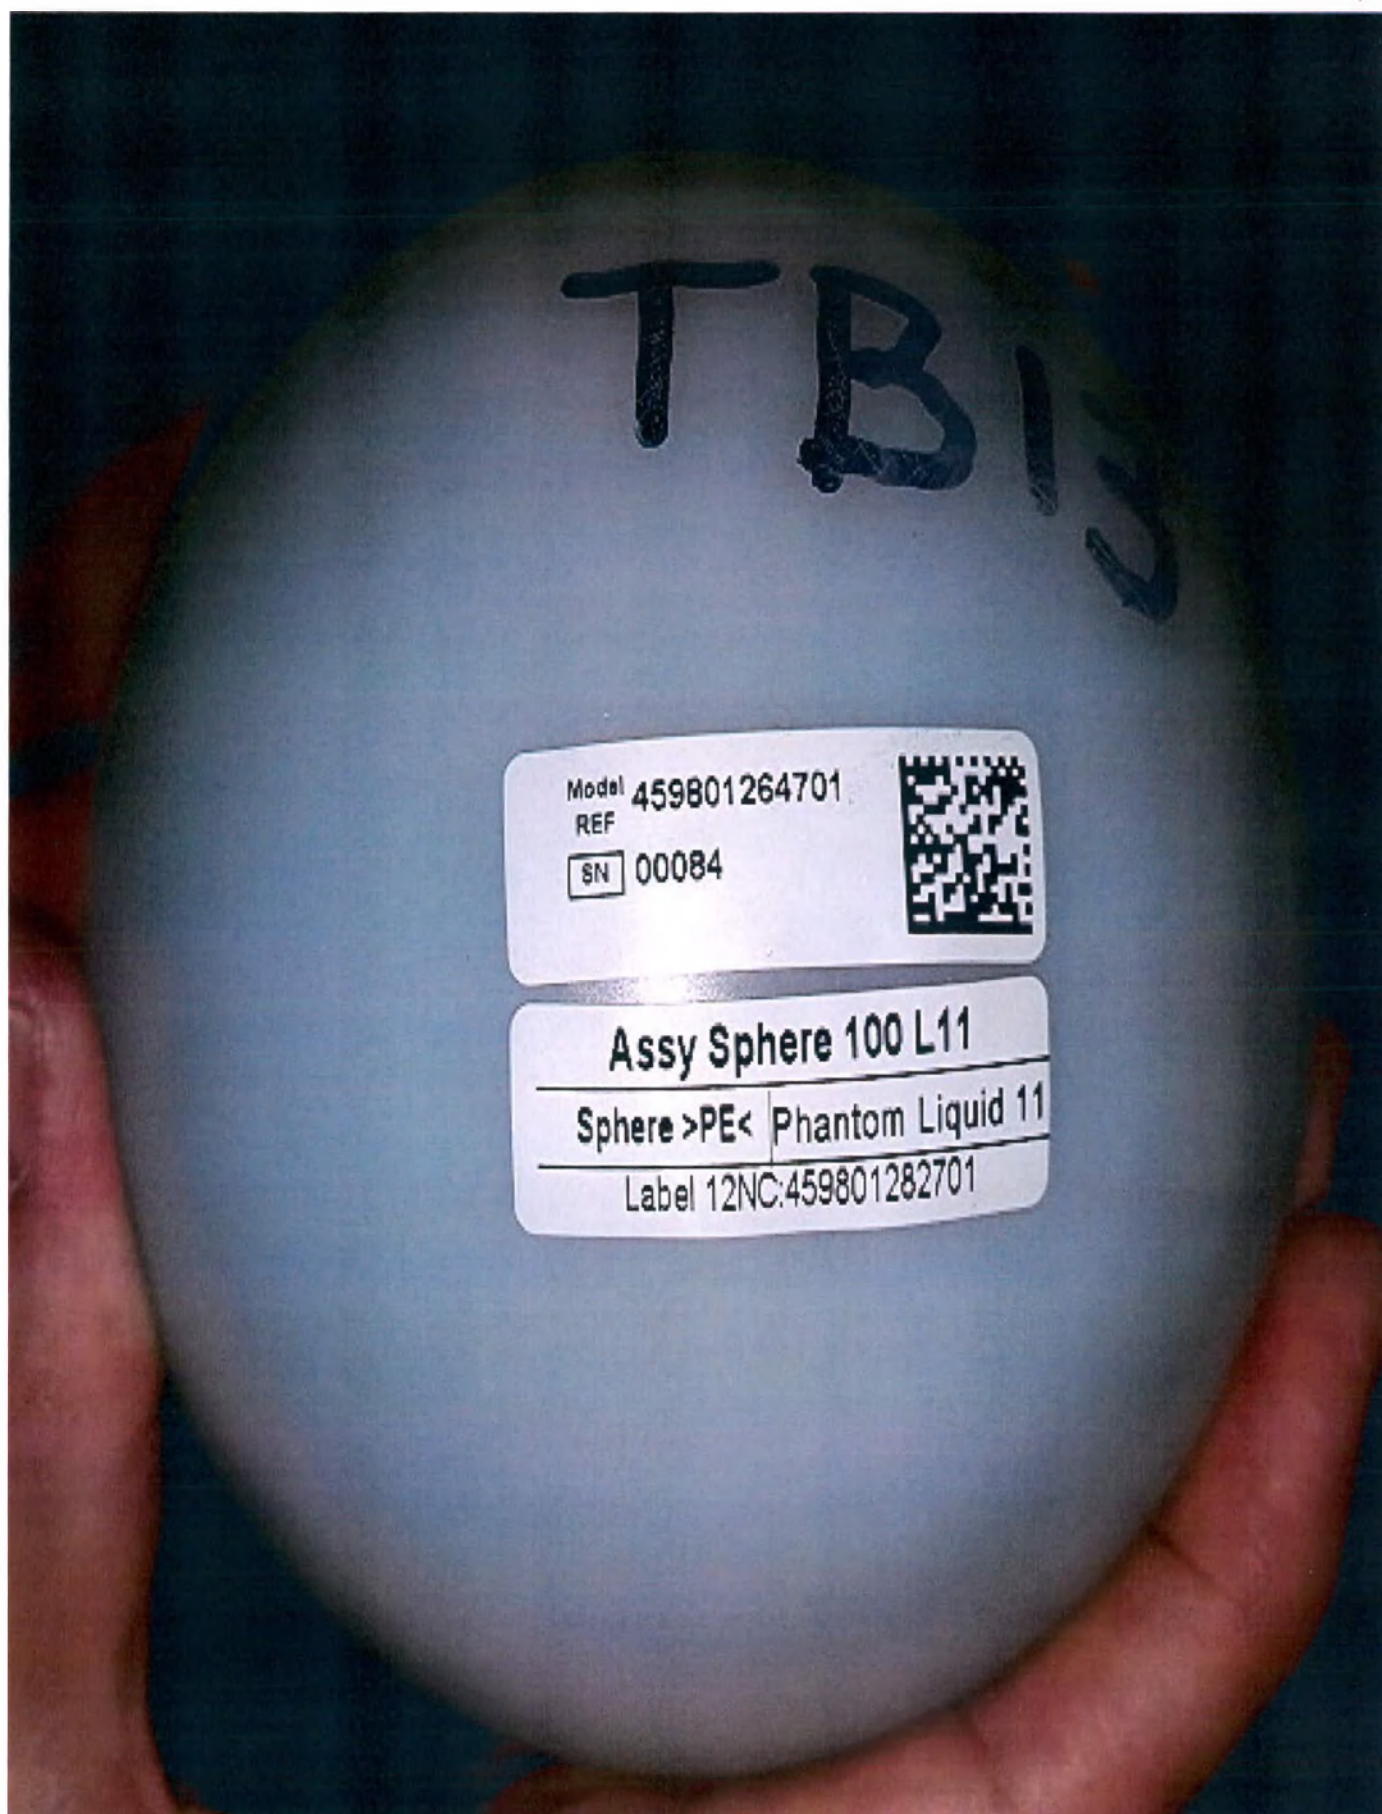

7.4 Сферический фантом.



7.5 Бутылочный фантом.

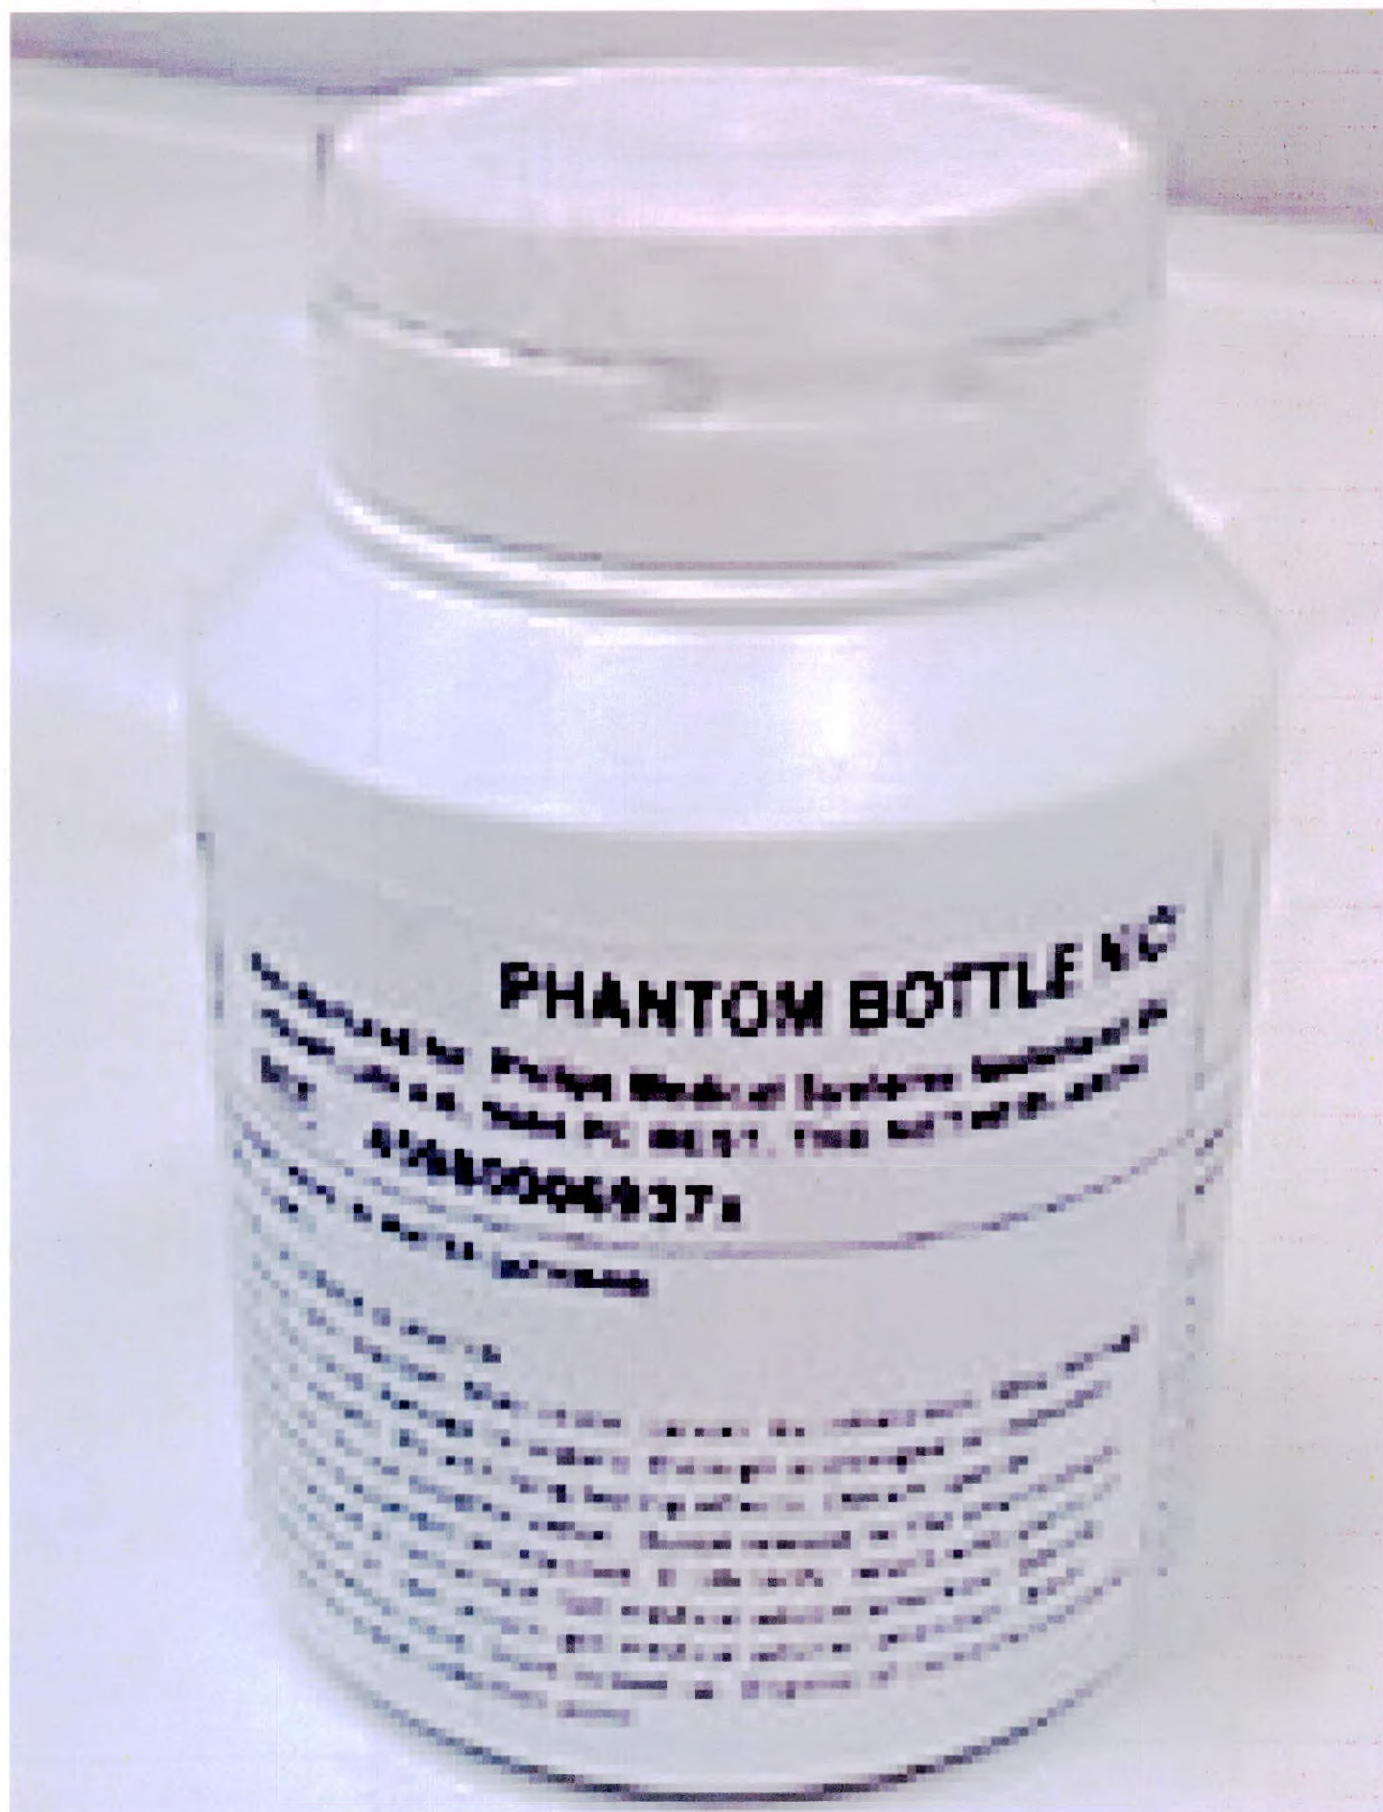

7.6 Бутылочный фантом (АЦПК).




7.7 Протонный сферический фантом А.



7.8 Фосфорный сферический фантом В.



7.9 Фосфорный дисковый фантом А.

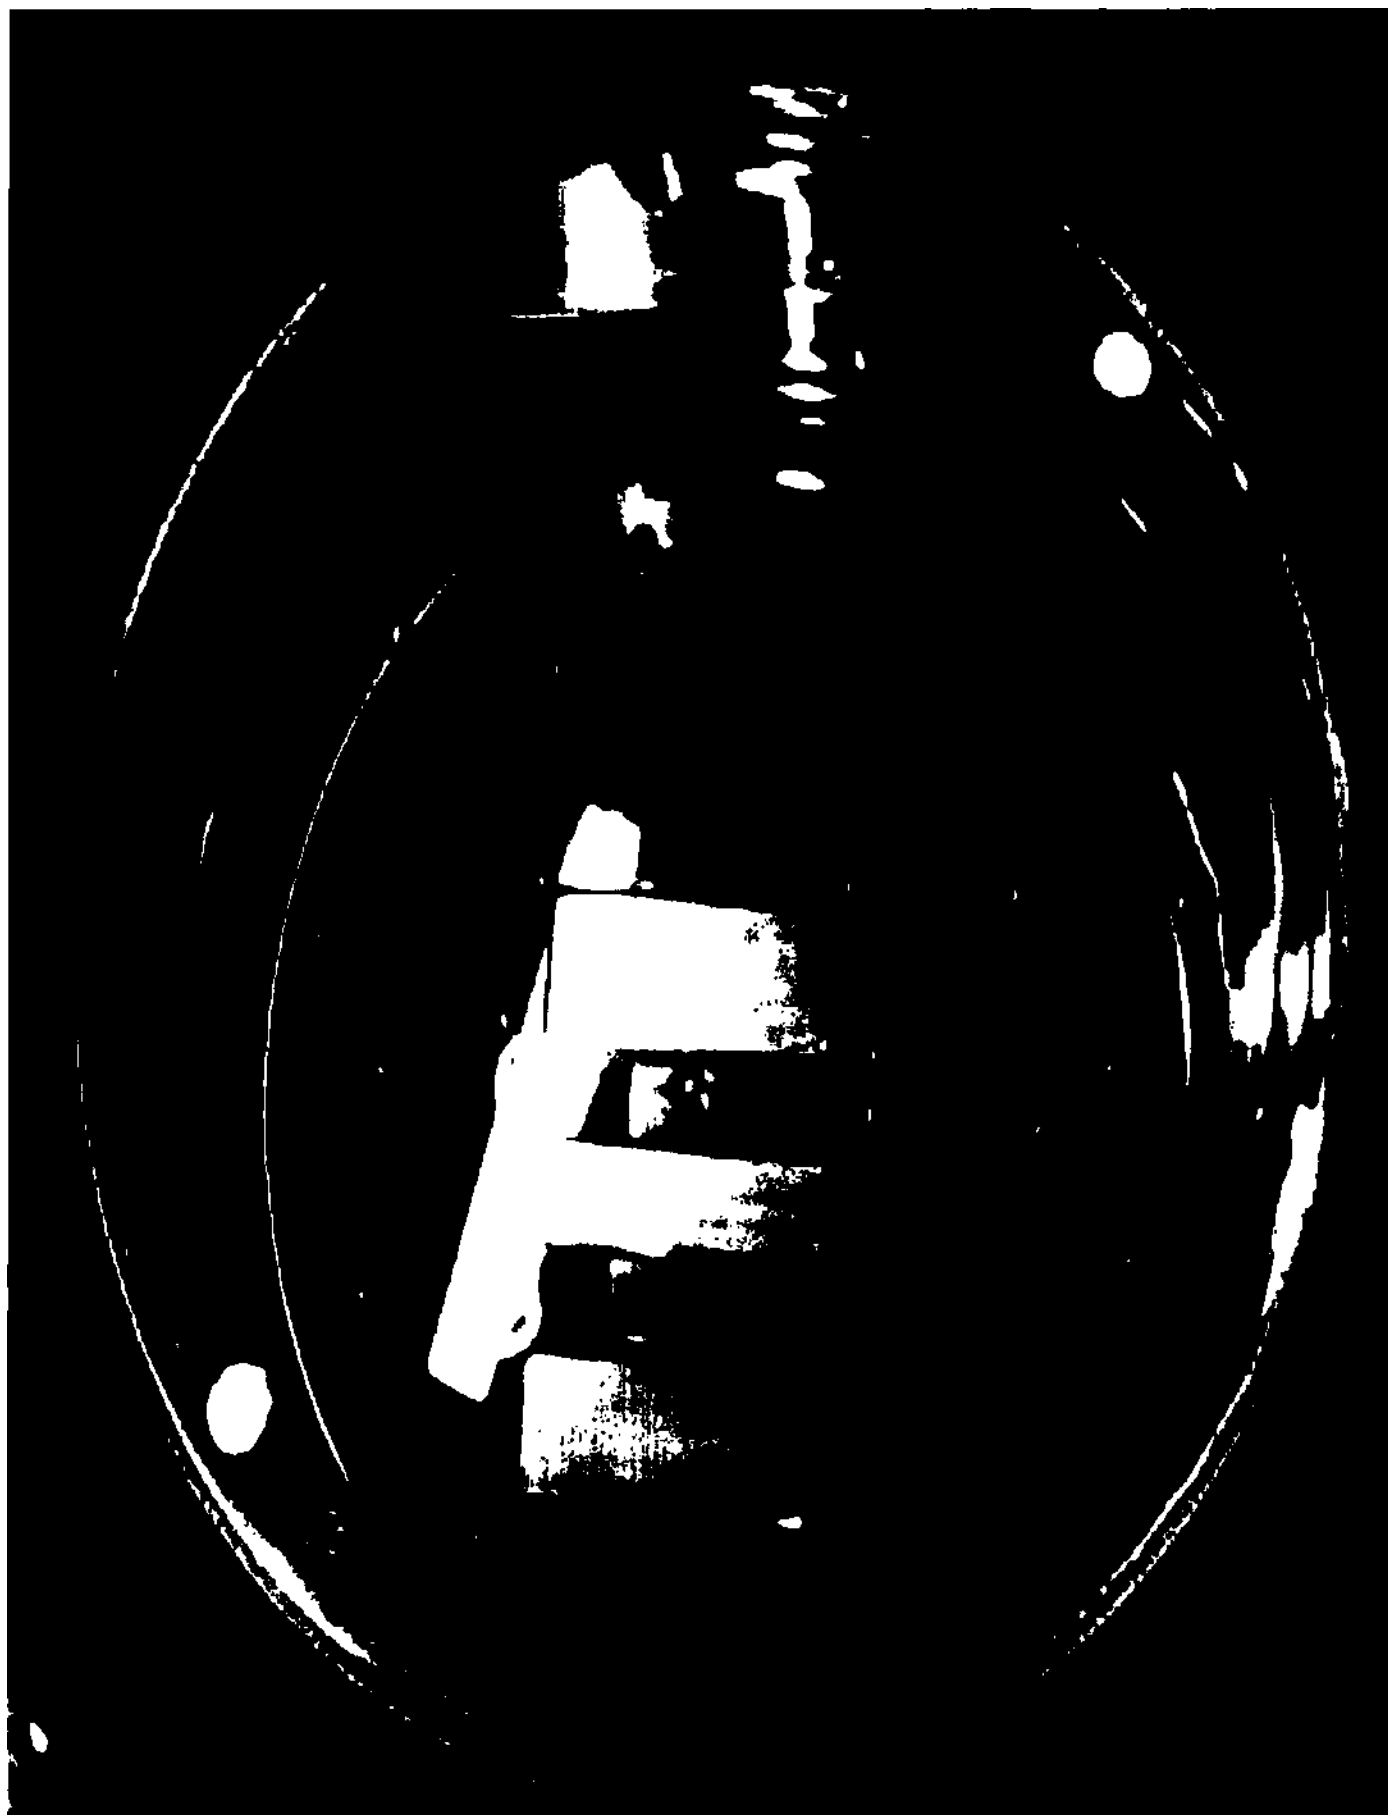



7.10 Фосфорный дисковый фантом В.






7. Разделитель кабелей.

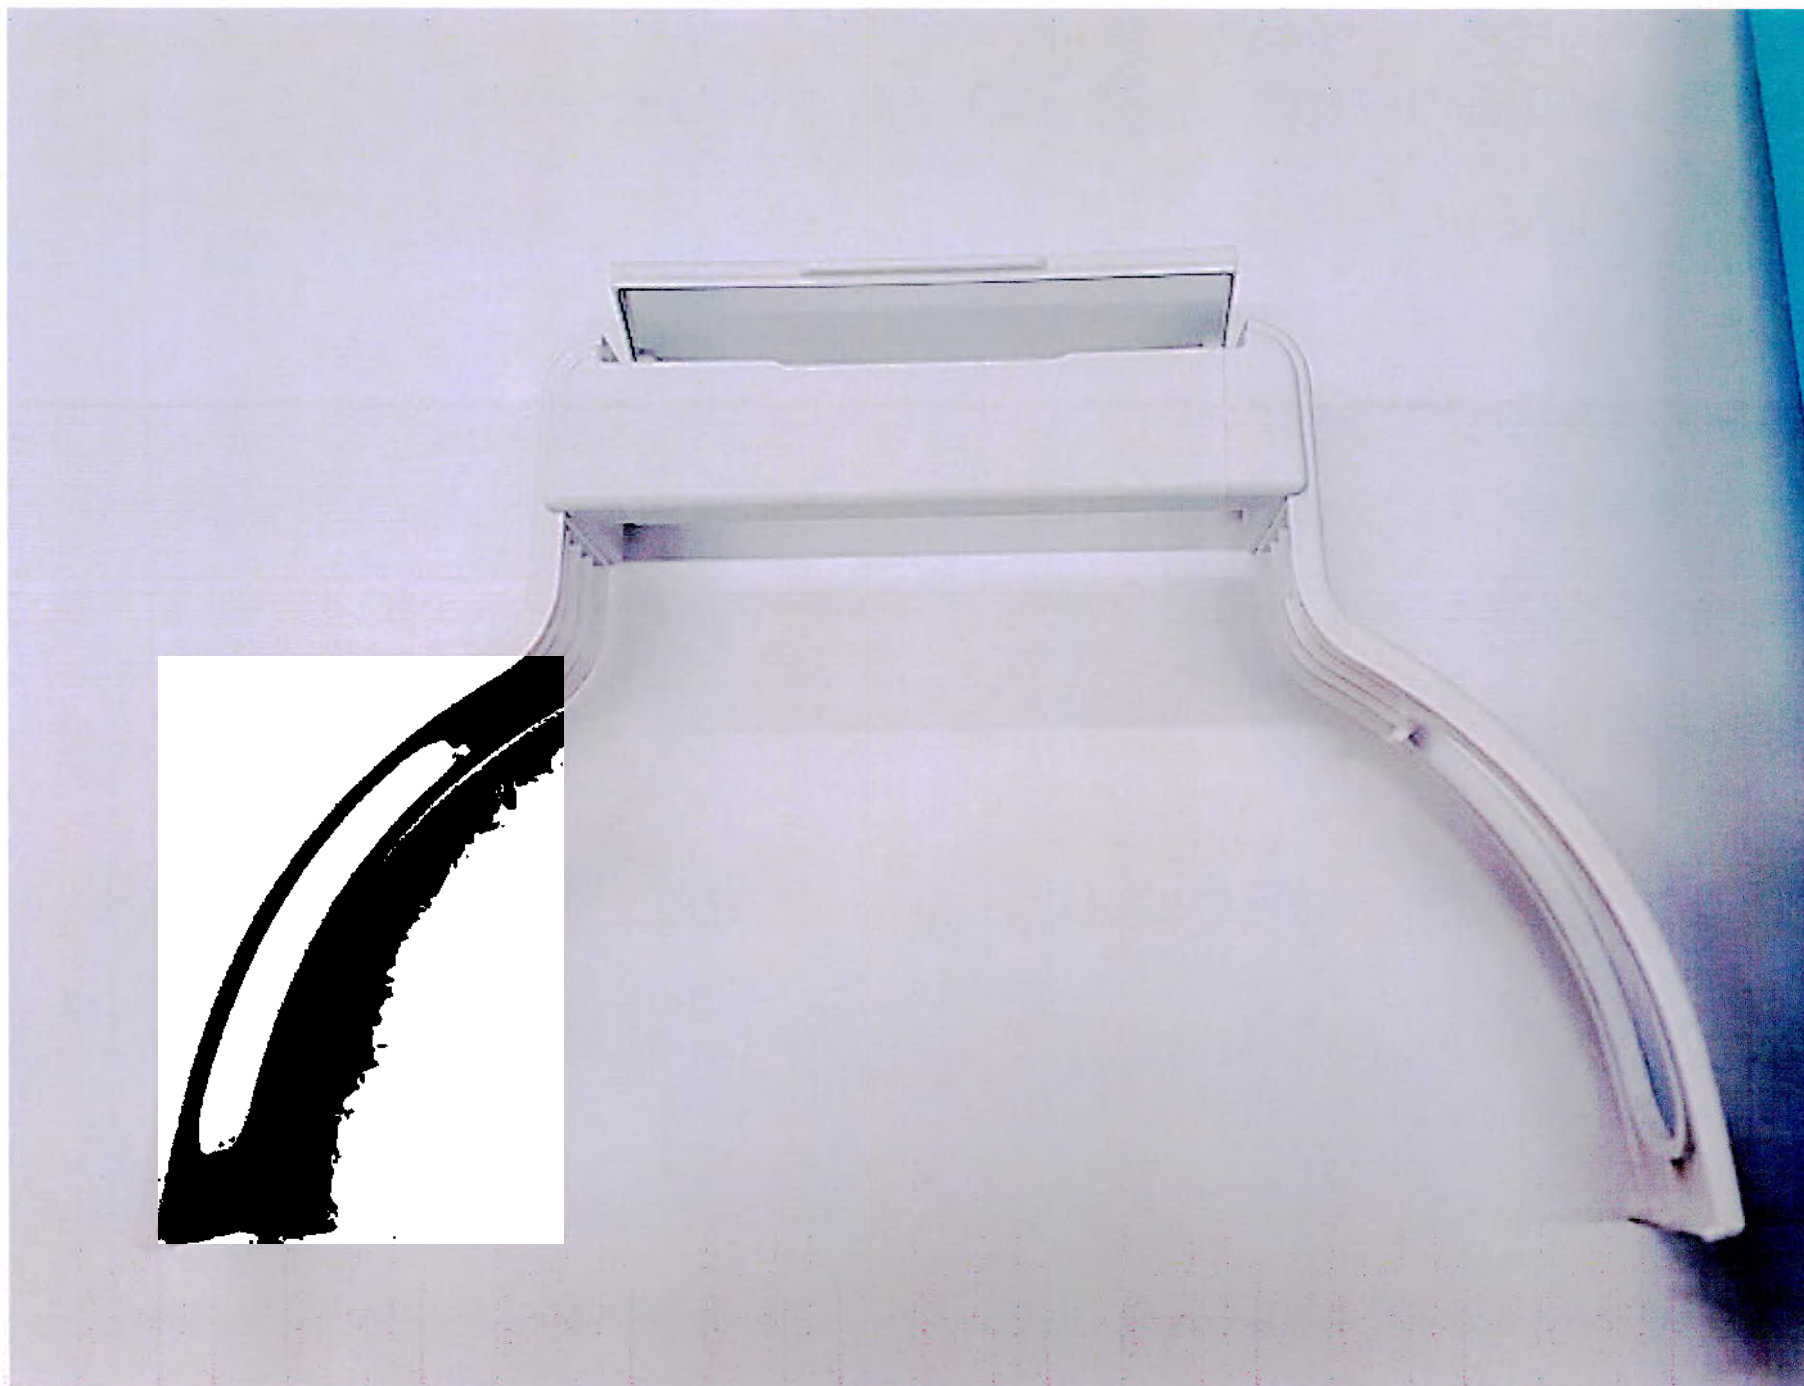

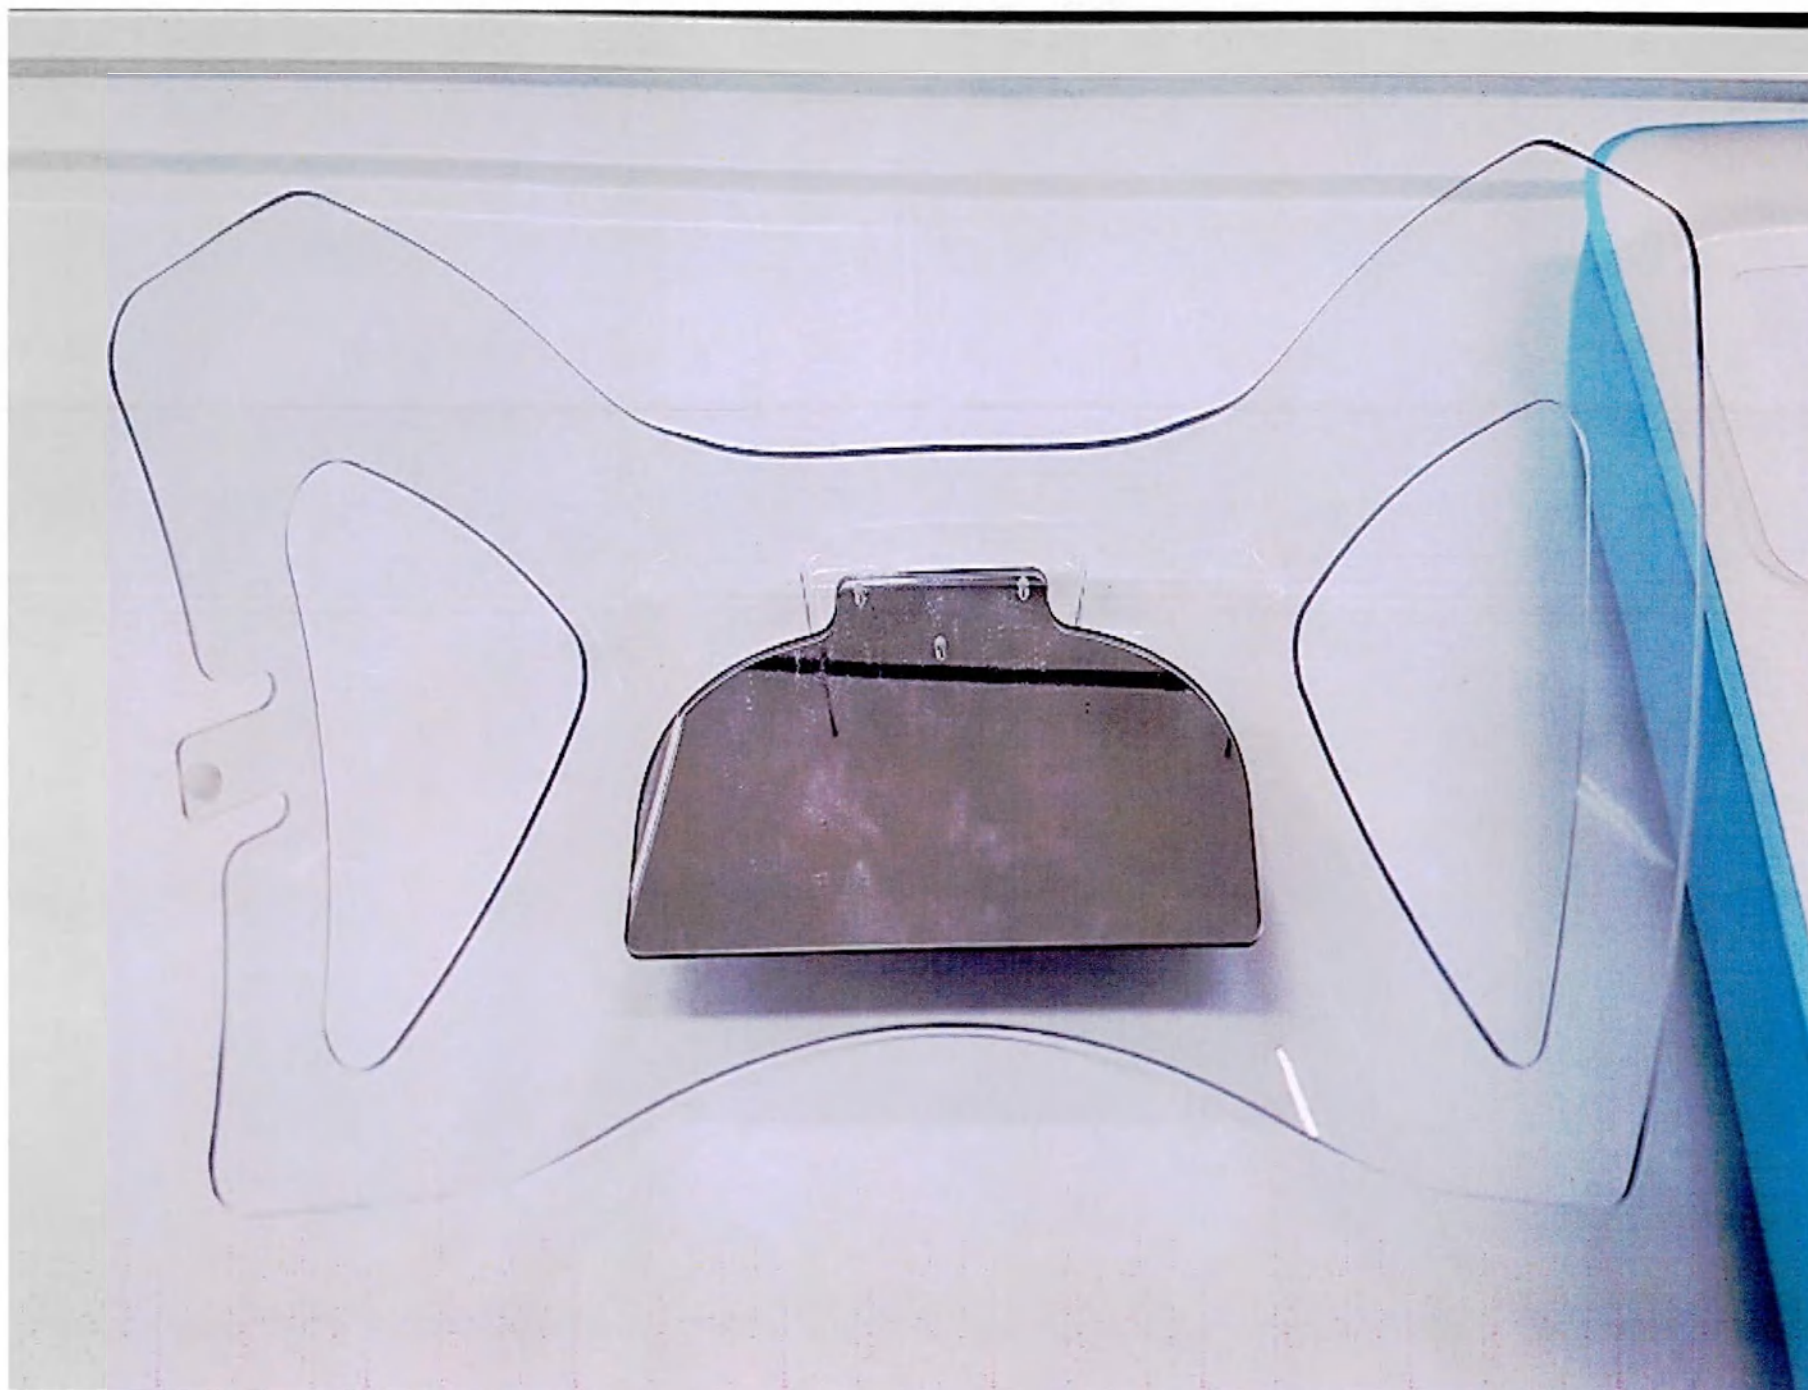

8. Зеркало. Вариант исполнения 2.

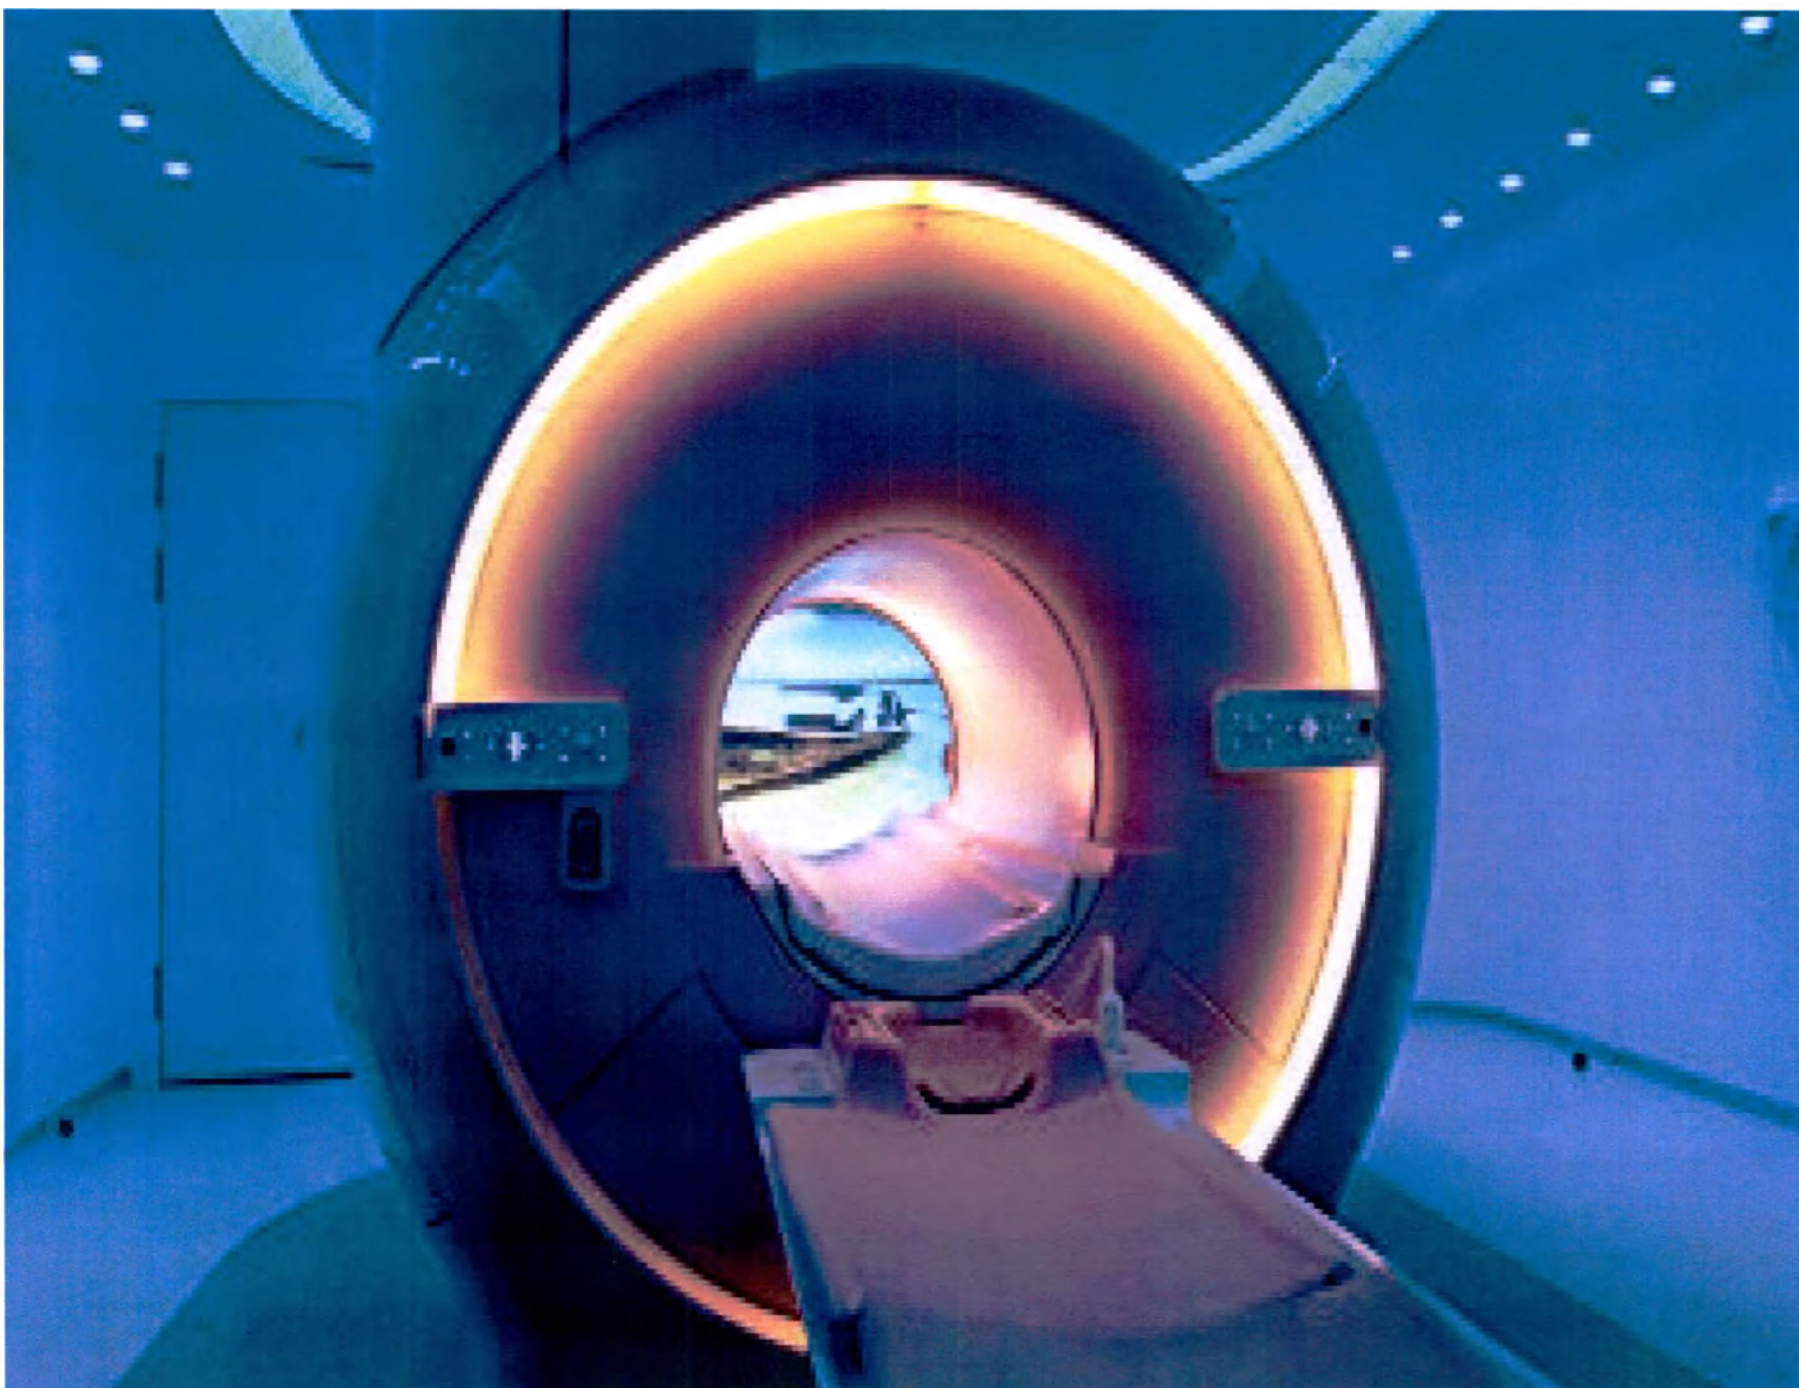




10. Источник бесперебойного питания.



11. Портативный металлодетектор.



12. Кабина радиочастотная для защитного экранирования помещения.

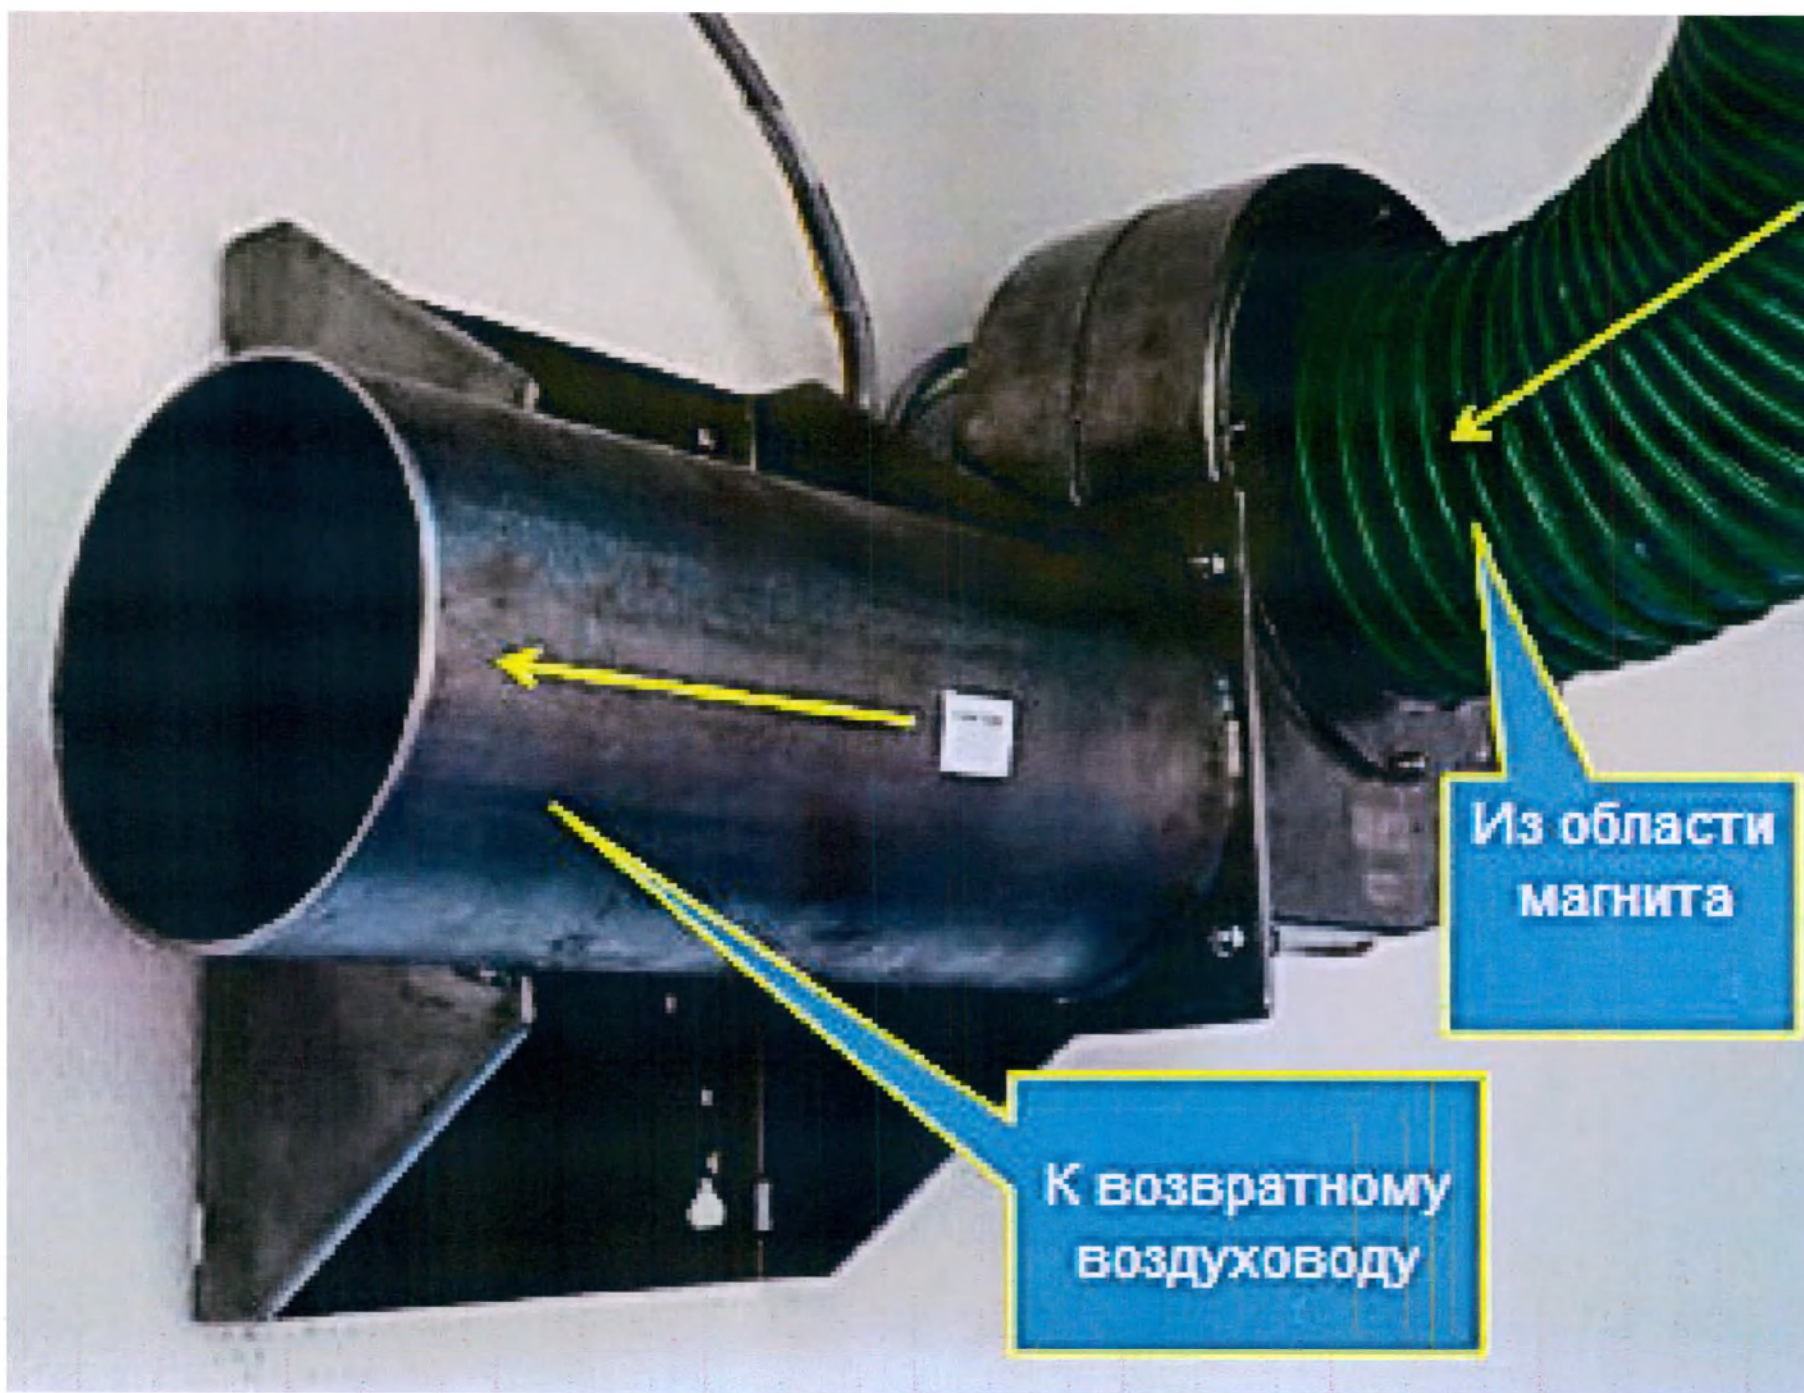


Из области
магнита


К возвратному
воздуховоду



15. Тележка пациента:

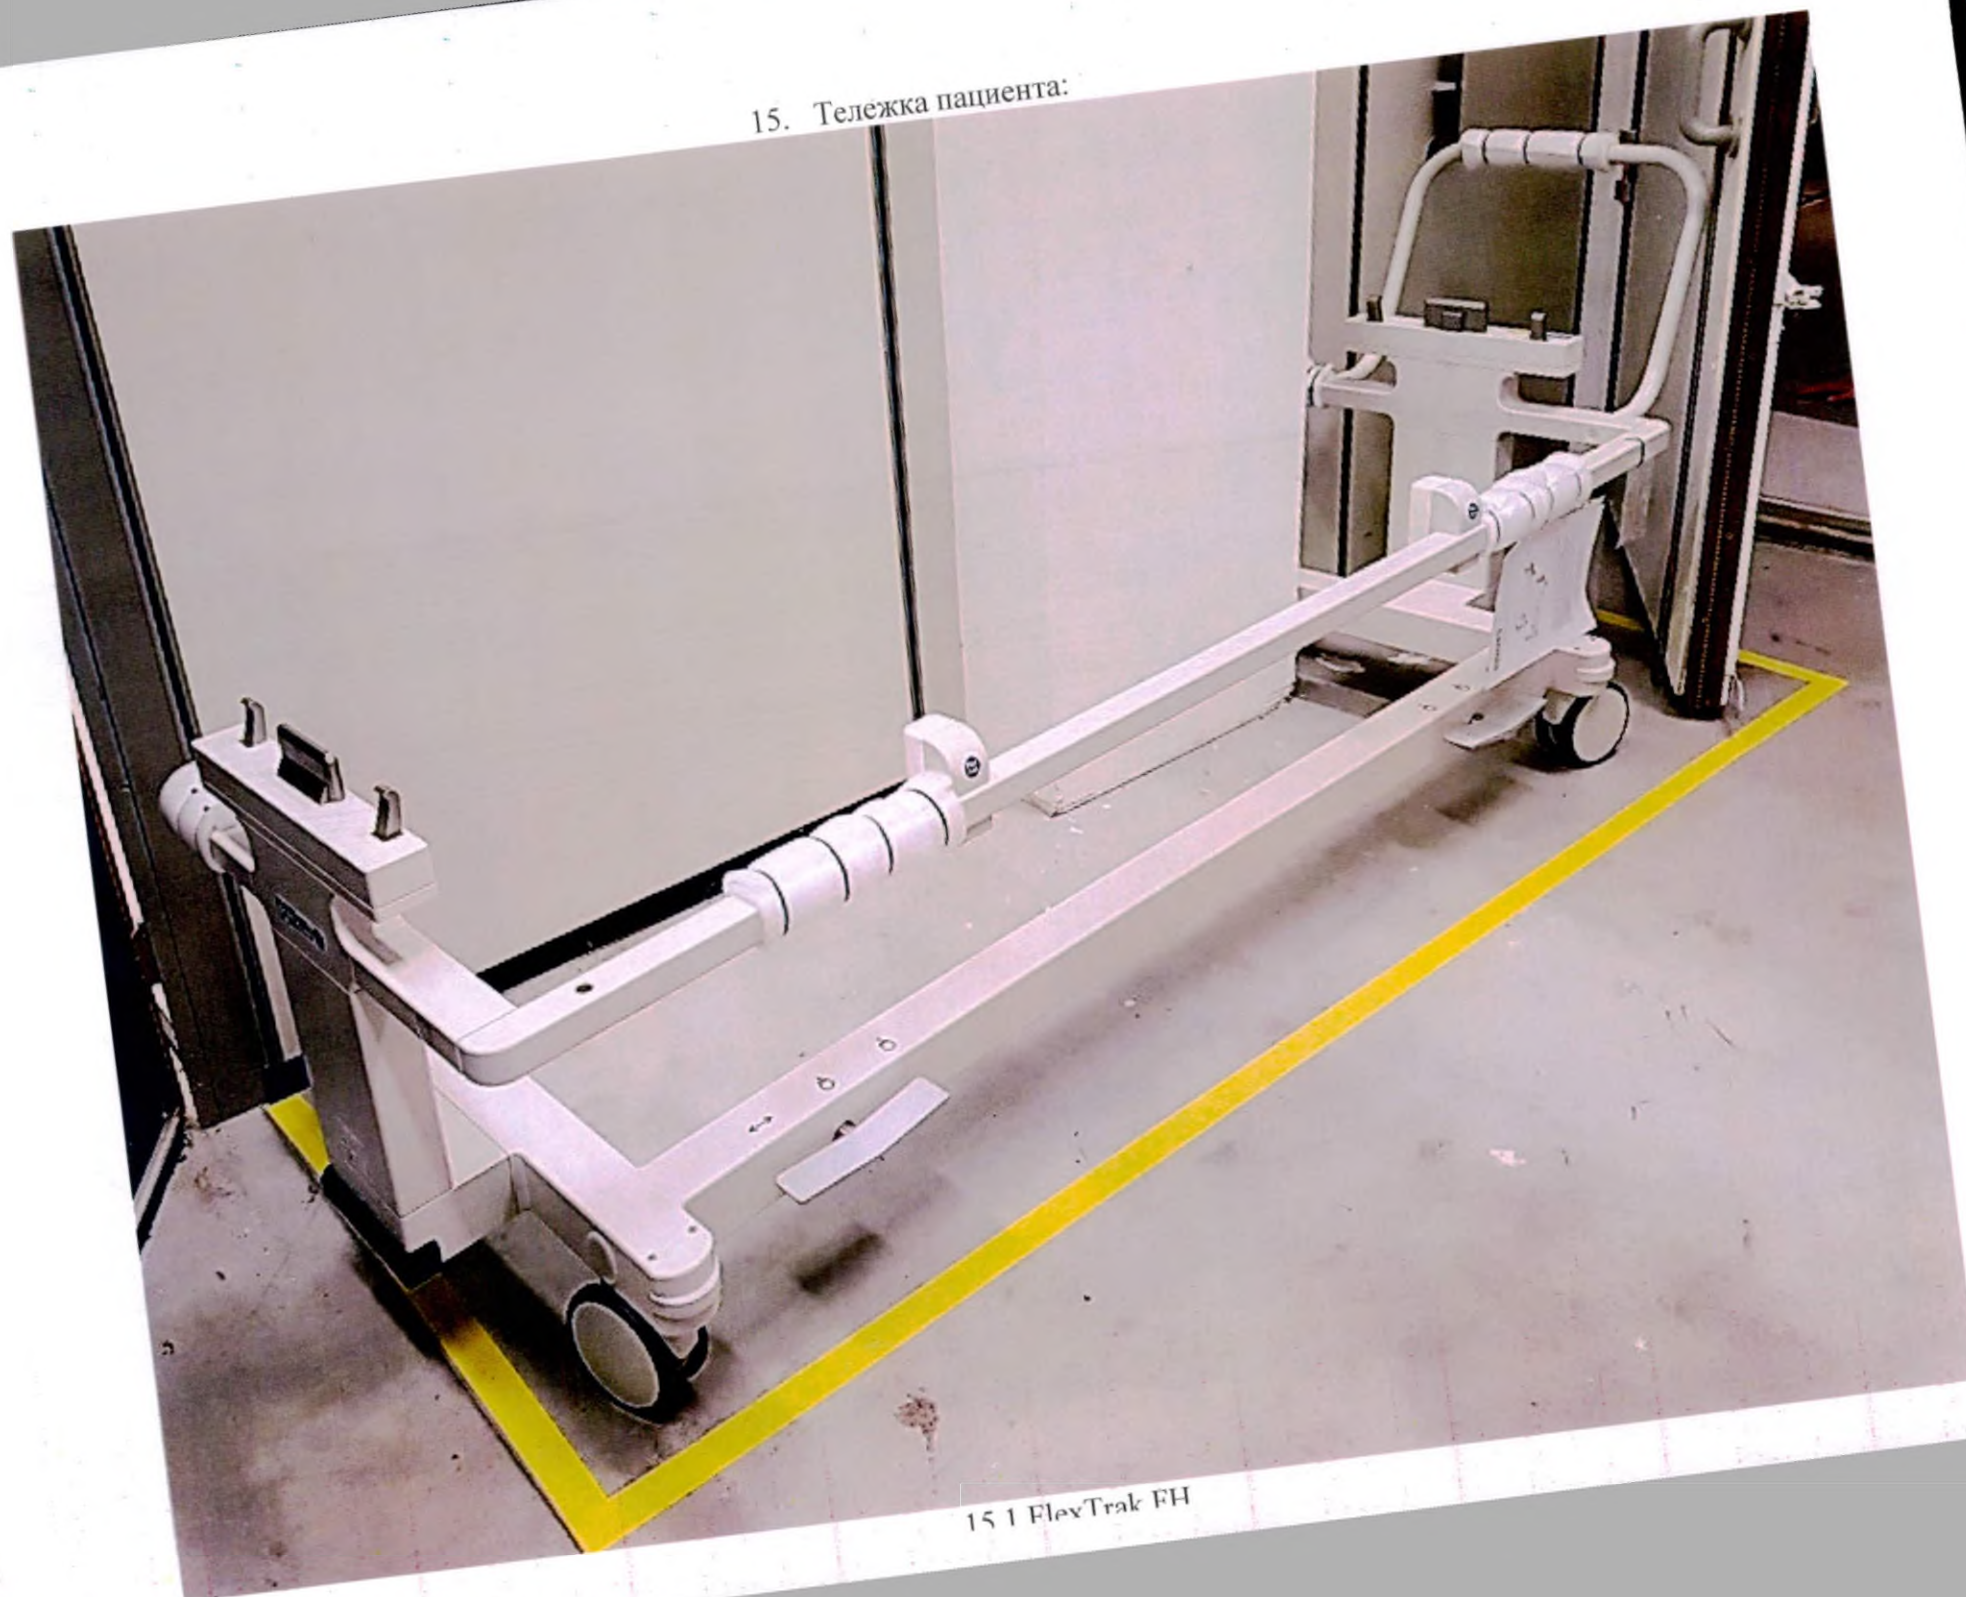

15 1 FlexTrak FH

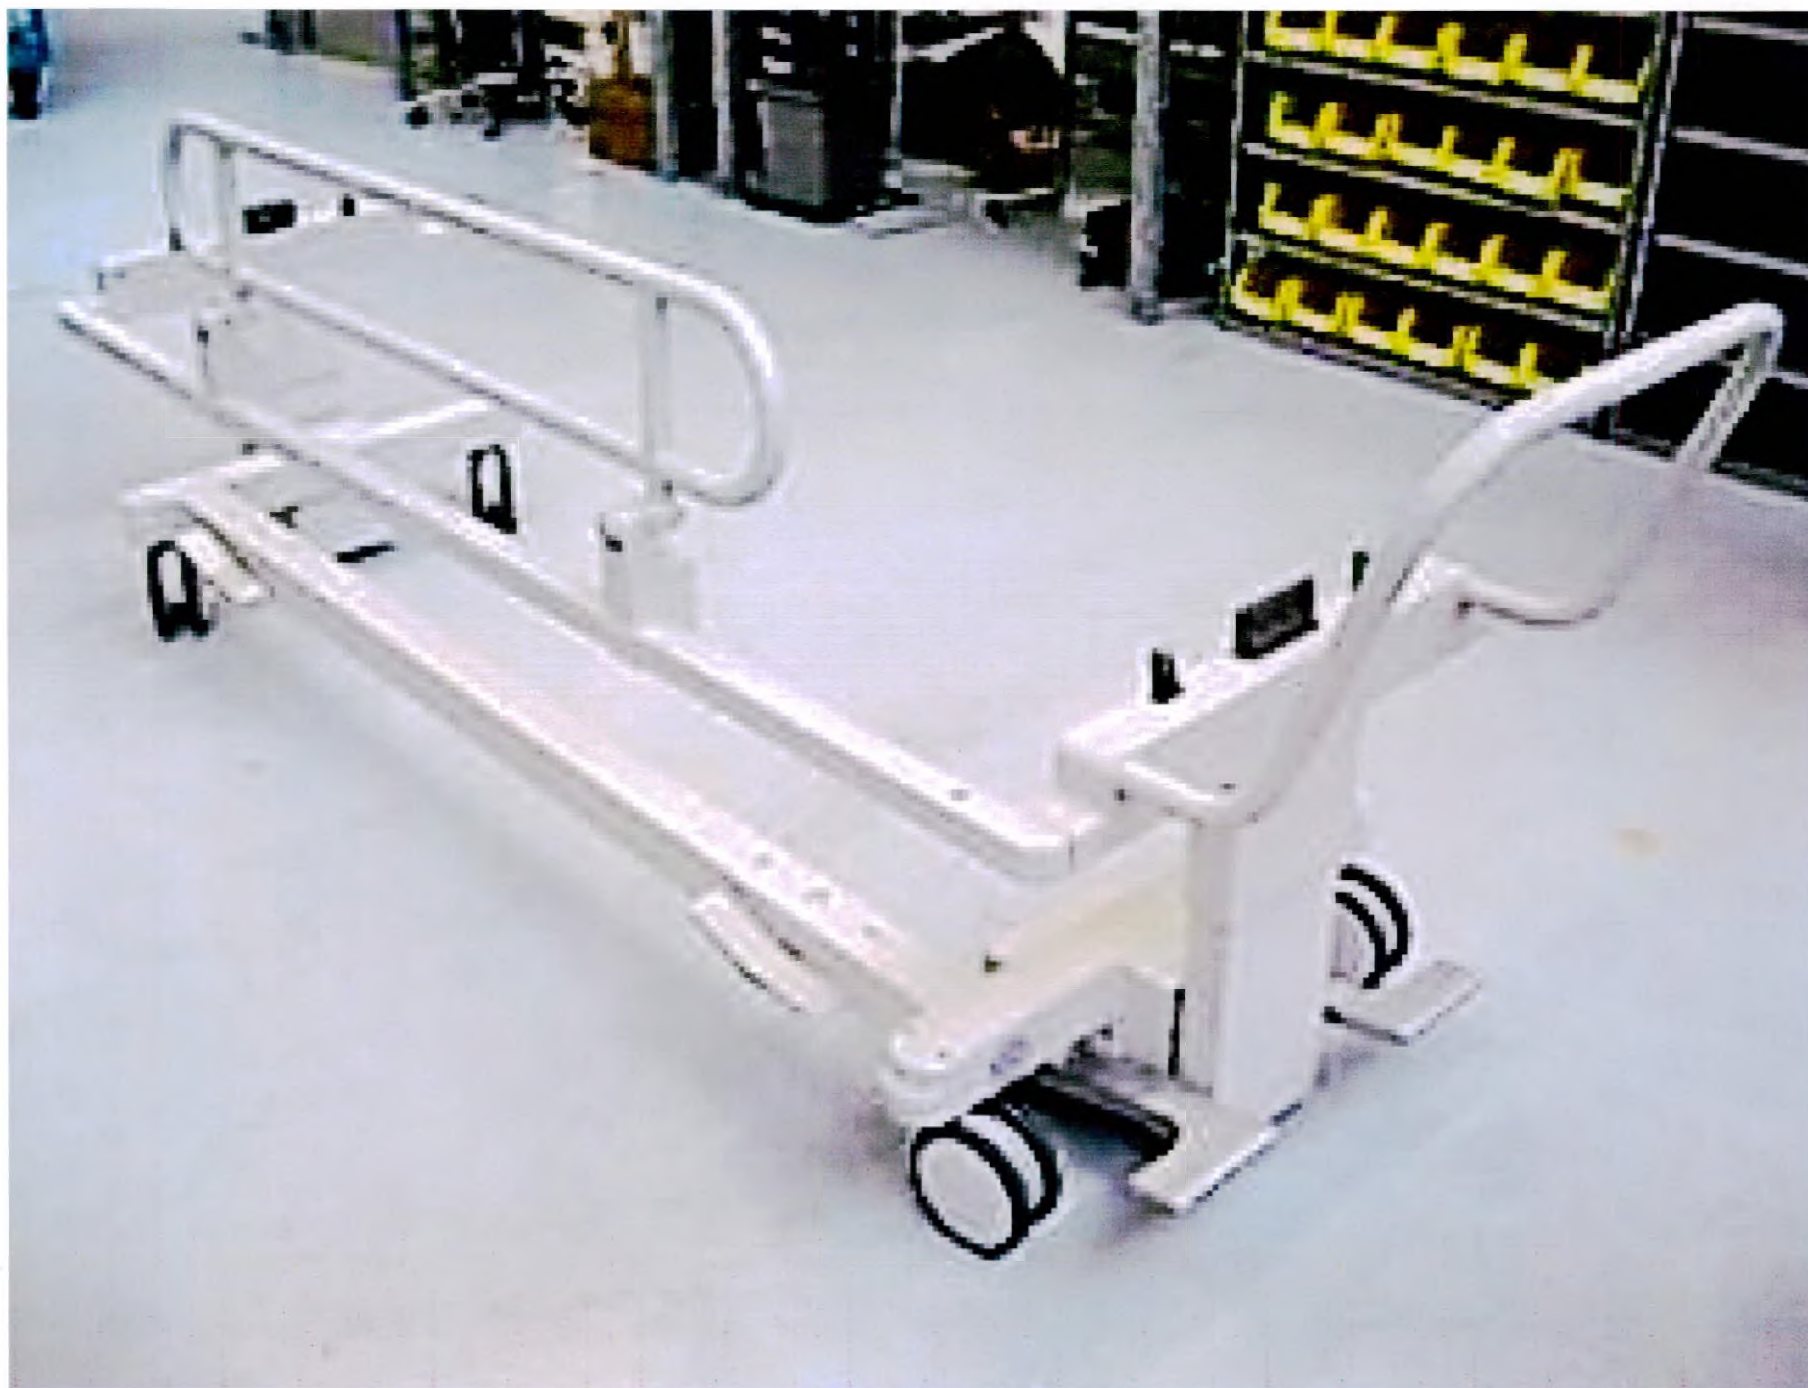

15.2 FlexTrak HA.



15.3 FlexTrak HA-II.




16. Специальное немагнитное противопожарное устройство.





17. Приспособления для позиционирования и монтажа. Сервисное приспособление (немагнитная стремянка).

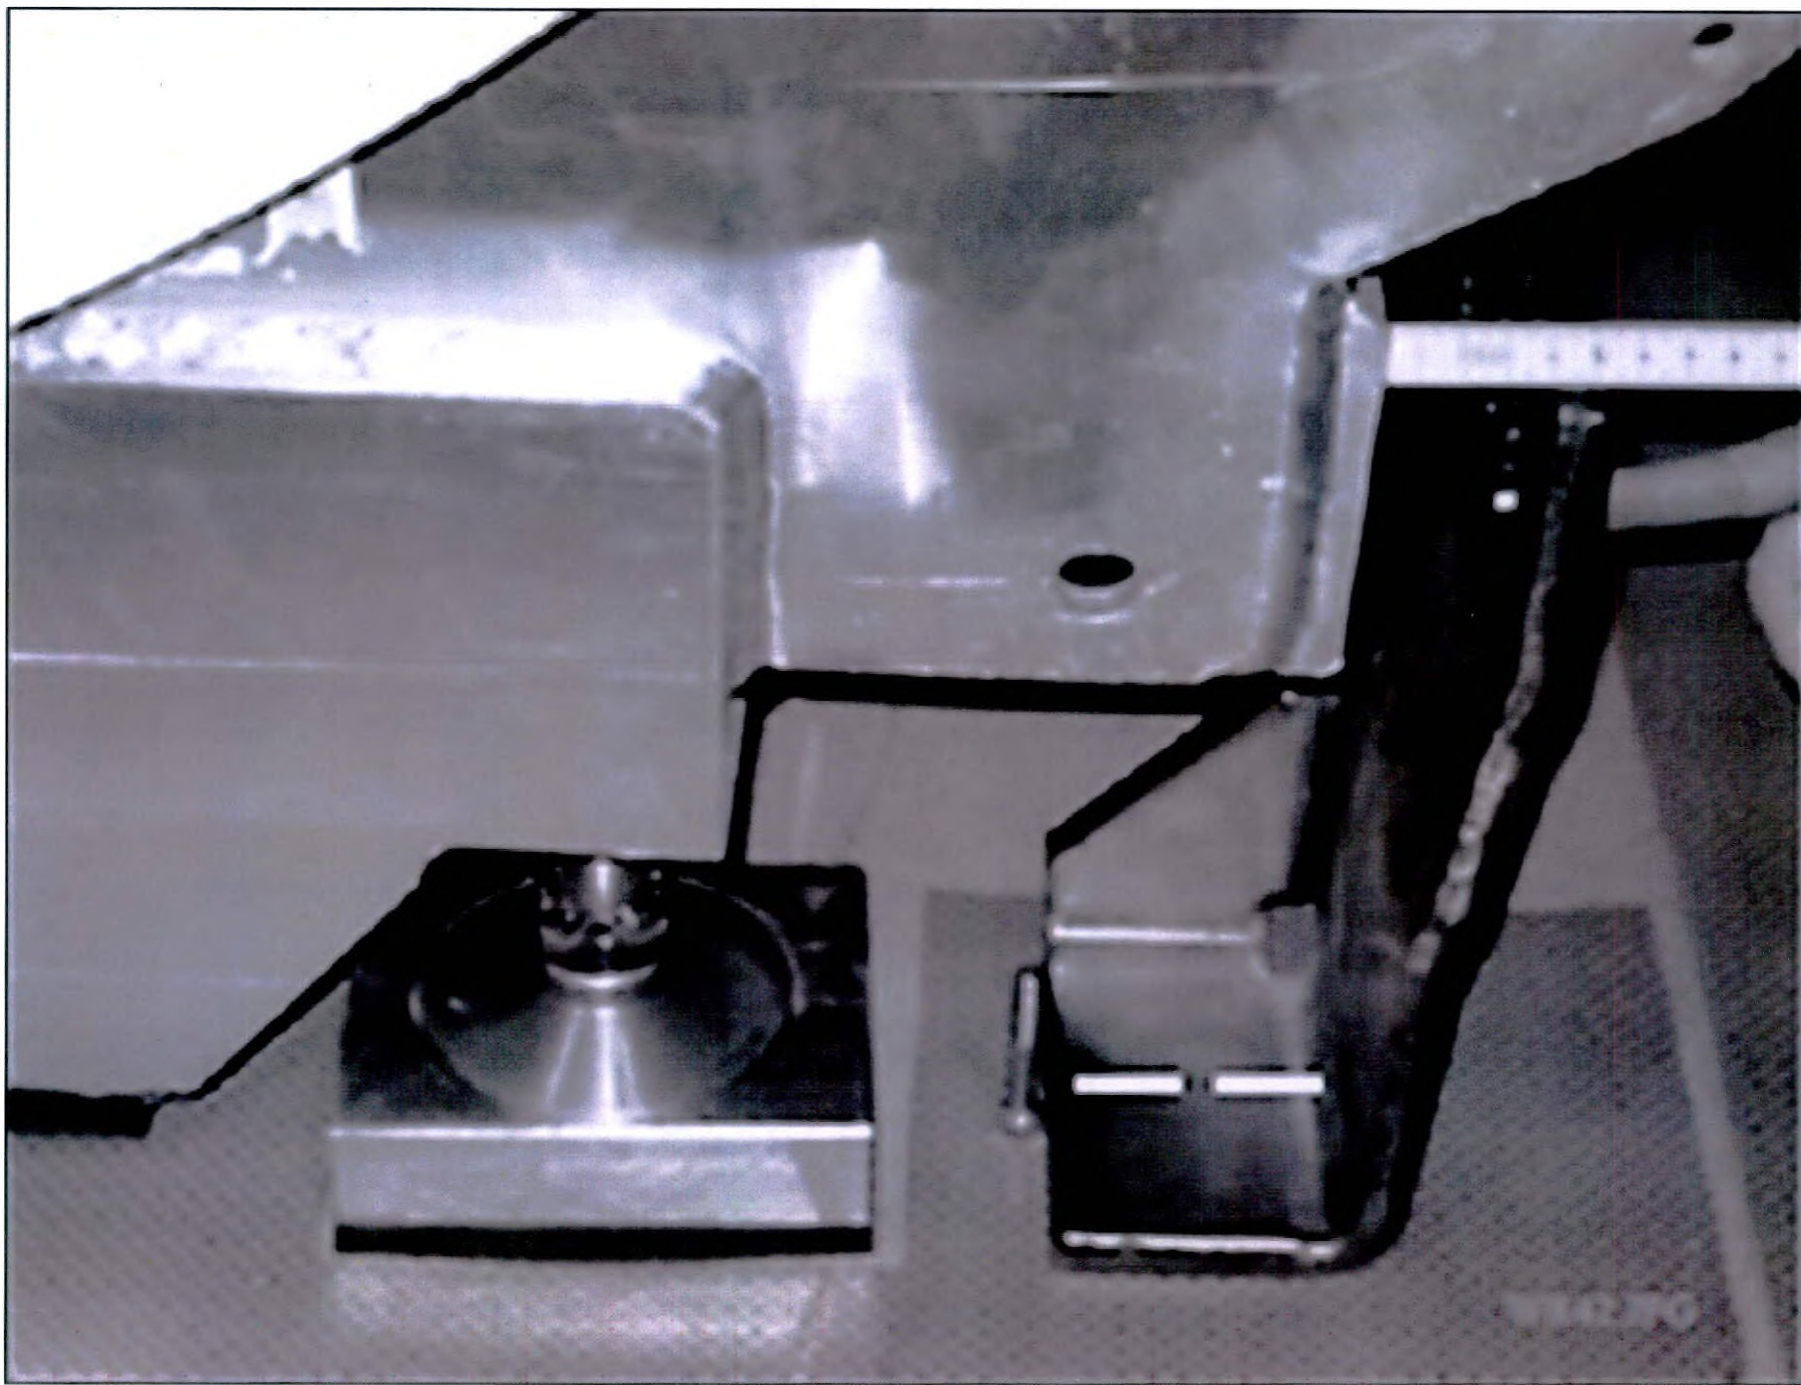










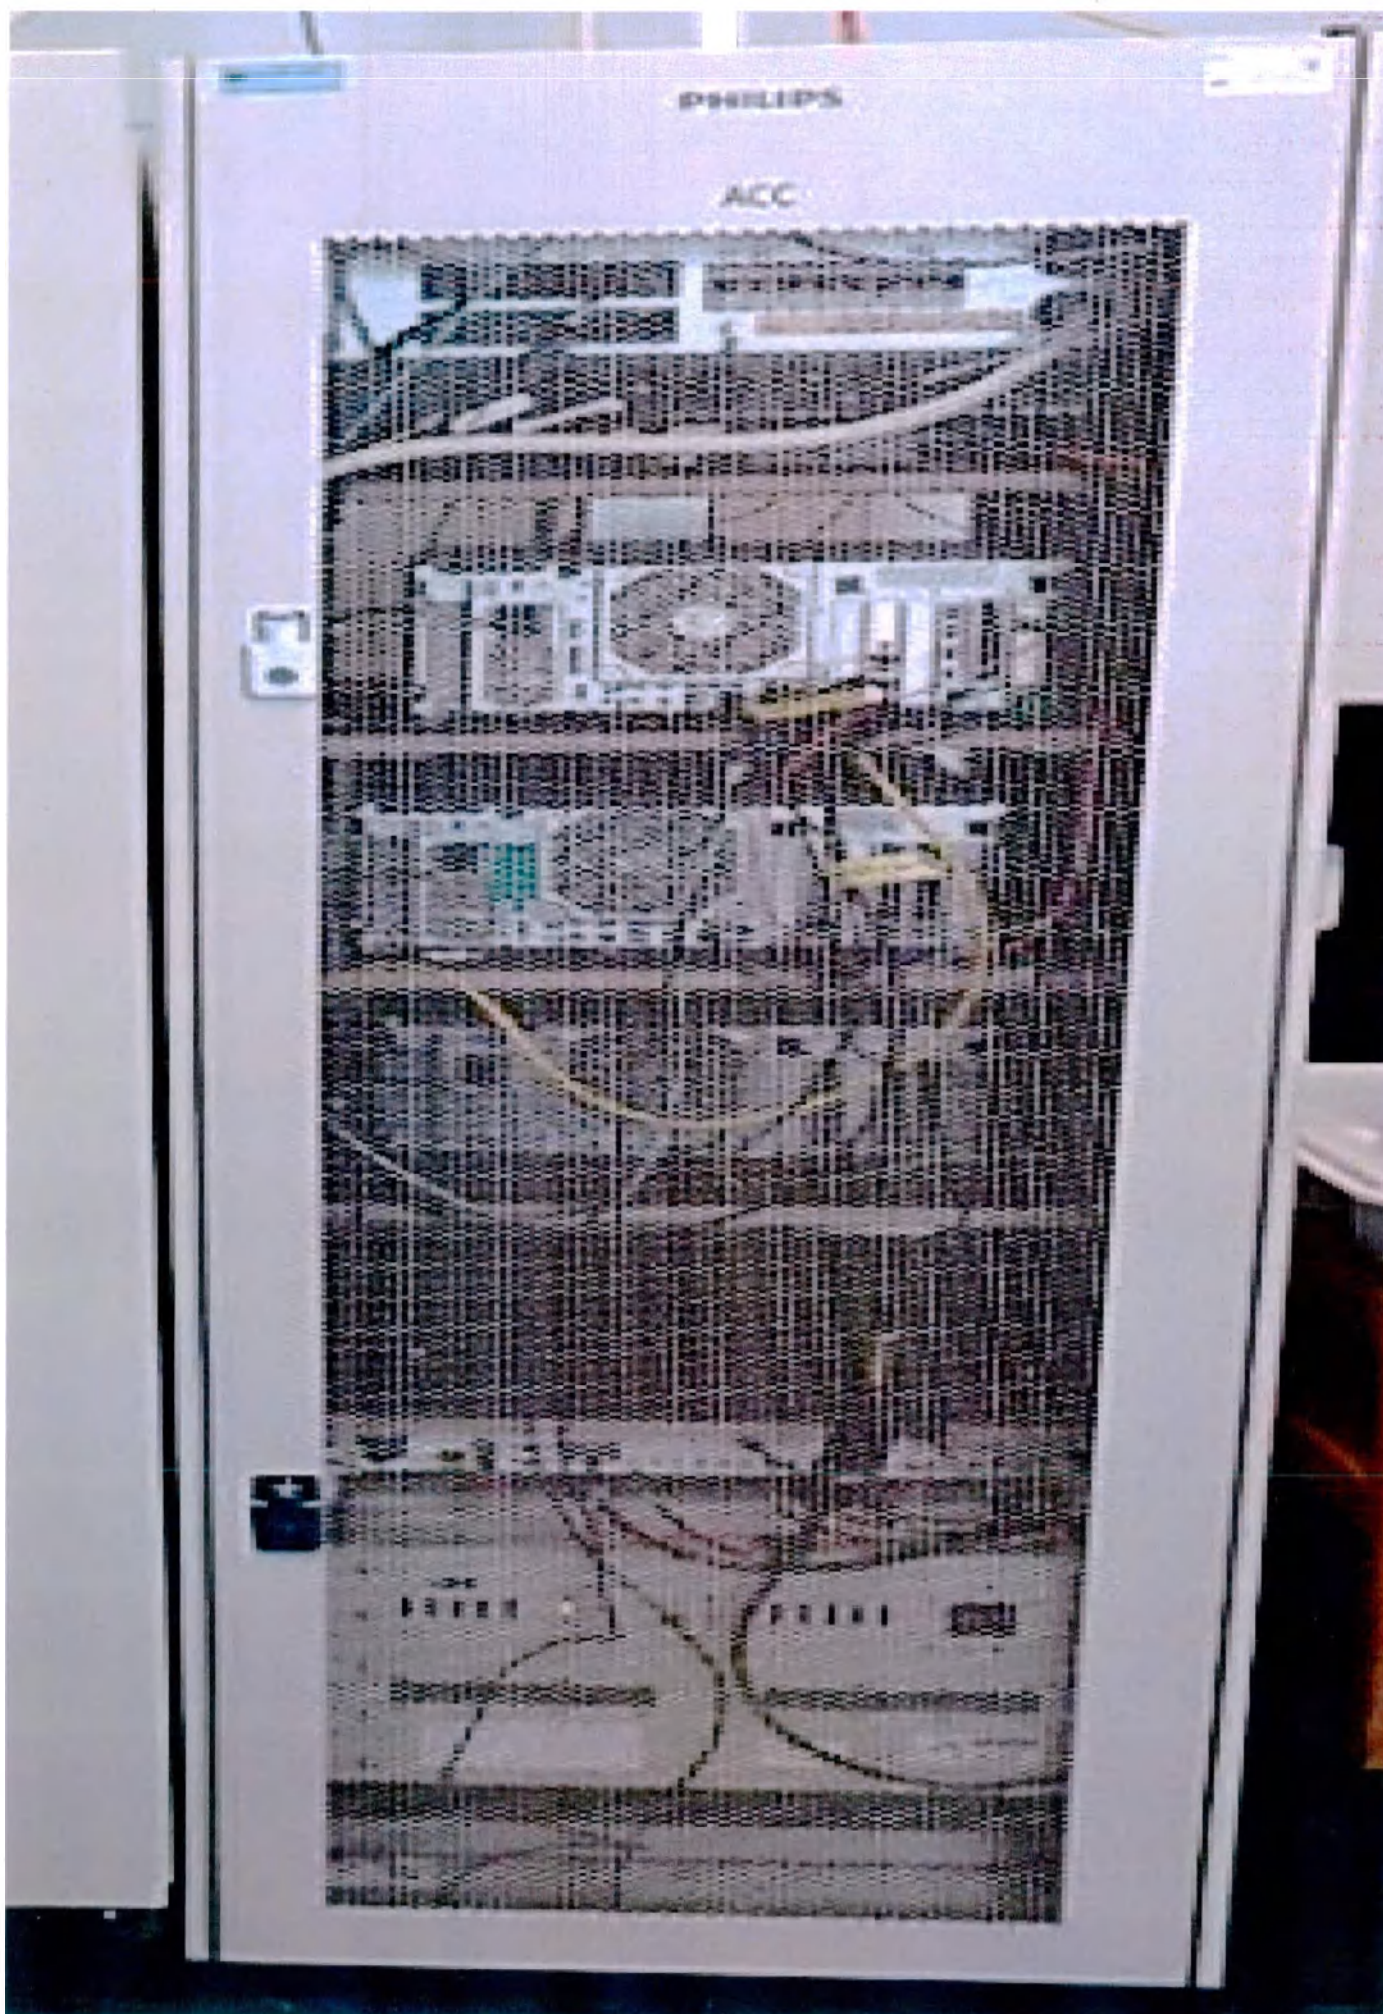

21. Система для дополнительных компонентов ACC.





Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 156 листа (ов)

ООО «Филипс»

