

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов

**производства Maccura Biotechnology Co., Ltd., 16#, Baichuan
Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China**



Общий вид МИ «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов»



Specification: 2 × 100 Tests

Storage: 2°C–8°C Protect from direct sunlight



Cat No.: IM4404056



Production date: 20230620



Lot No.: 1222081



Expiry date: 20240620



(01) 06950617423430
(10) 1222081
(11) 221220
(17) 240620
(21) SW2211010298001734

Anti-TG (CLIA)

Anti-TG



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид спереди «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司
住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号
电话: + 86 28 8782 6777
传真: + 86 28 8782 5783
邮编: 611731
邮箱: maccura@maccura.com




Maccura Biotechnology Co., Ltd.
Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731
Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86 28 8782 6777
Fax: +86 28 8782 5783
E-mail: maccura@maccura.com

www.maccura.com



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов»

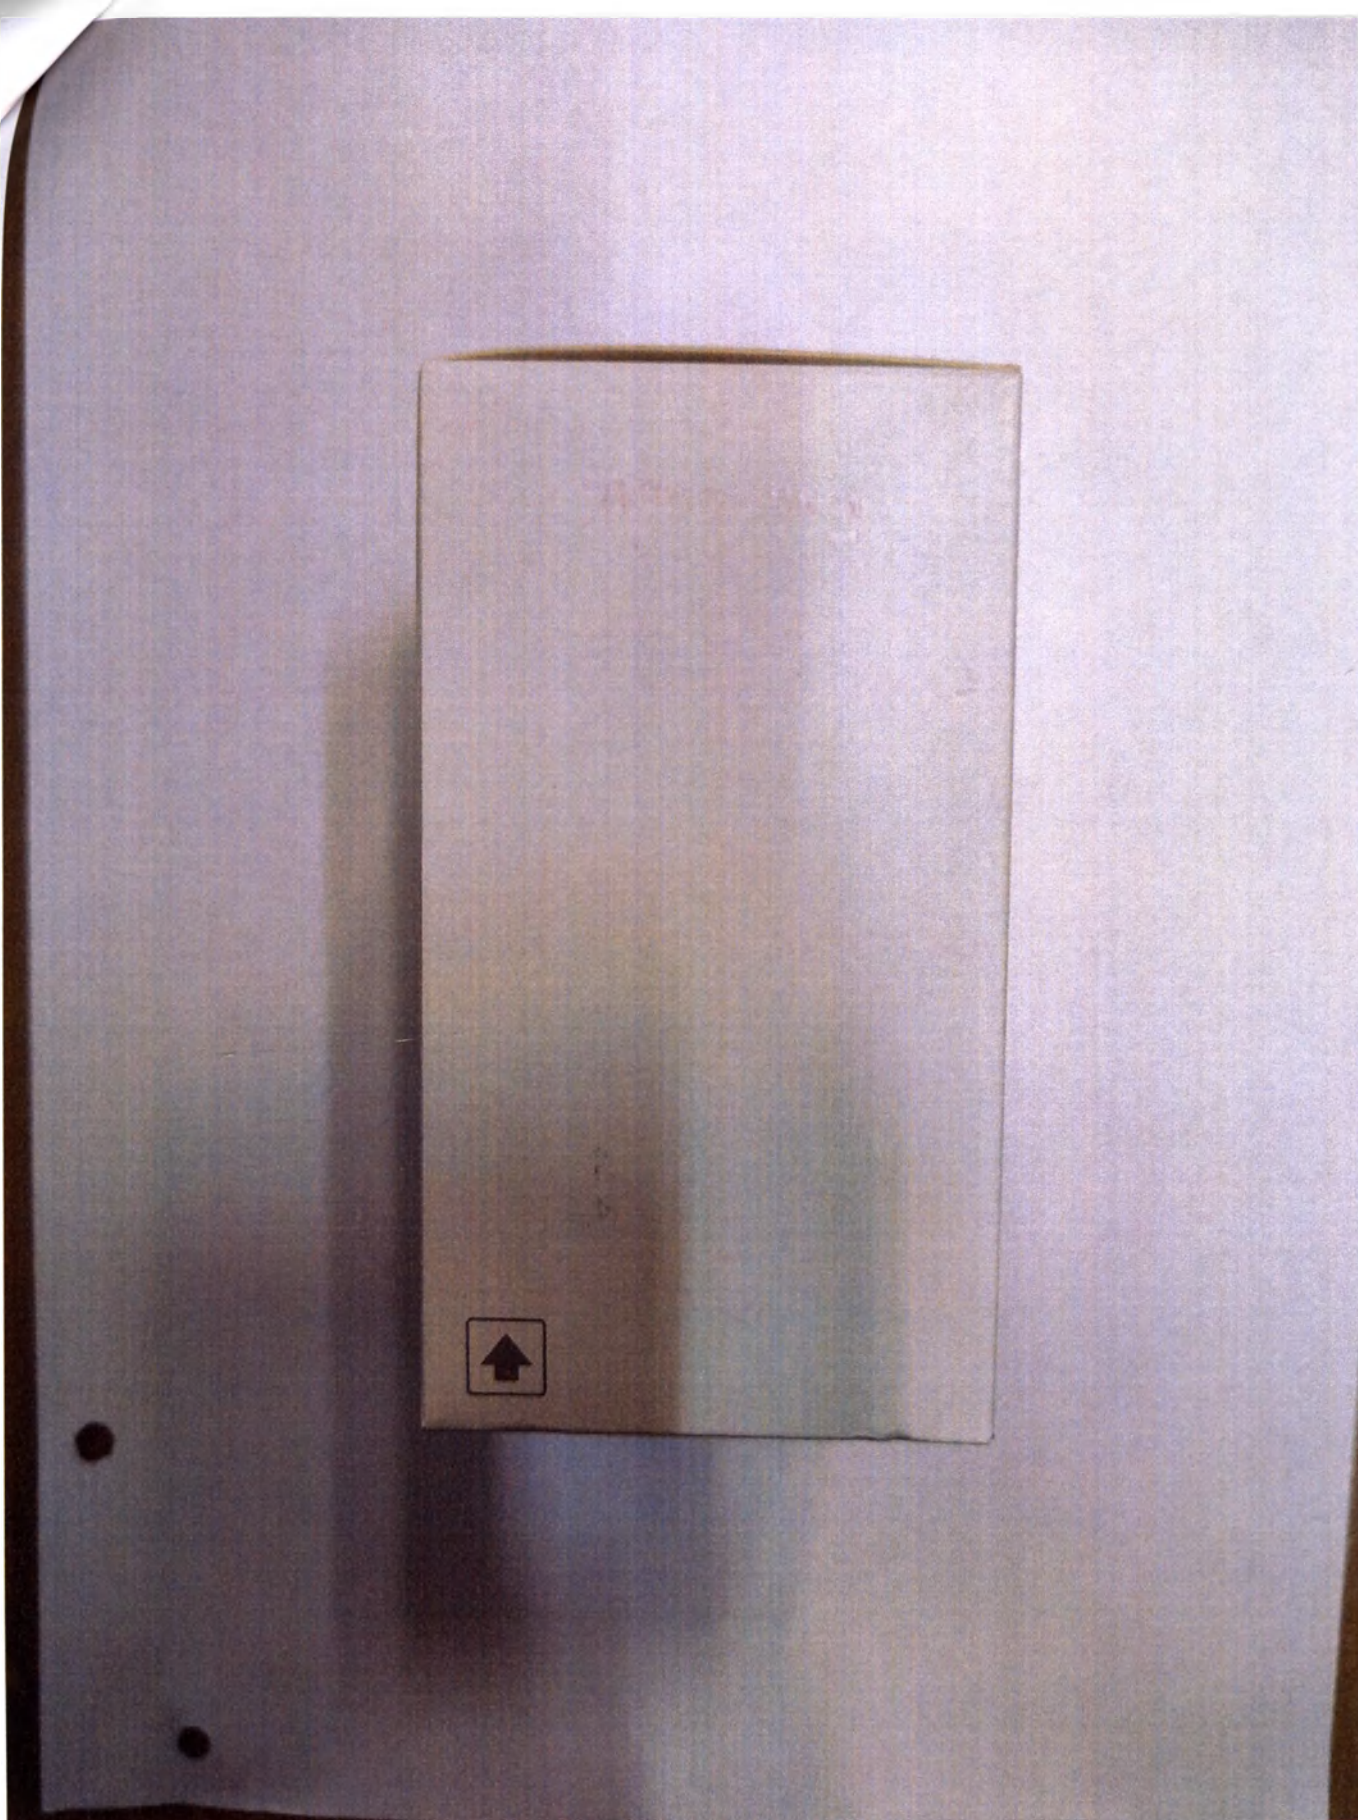


Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура і (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов»




Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2 «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов»

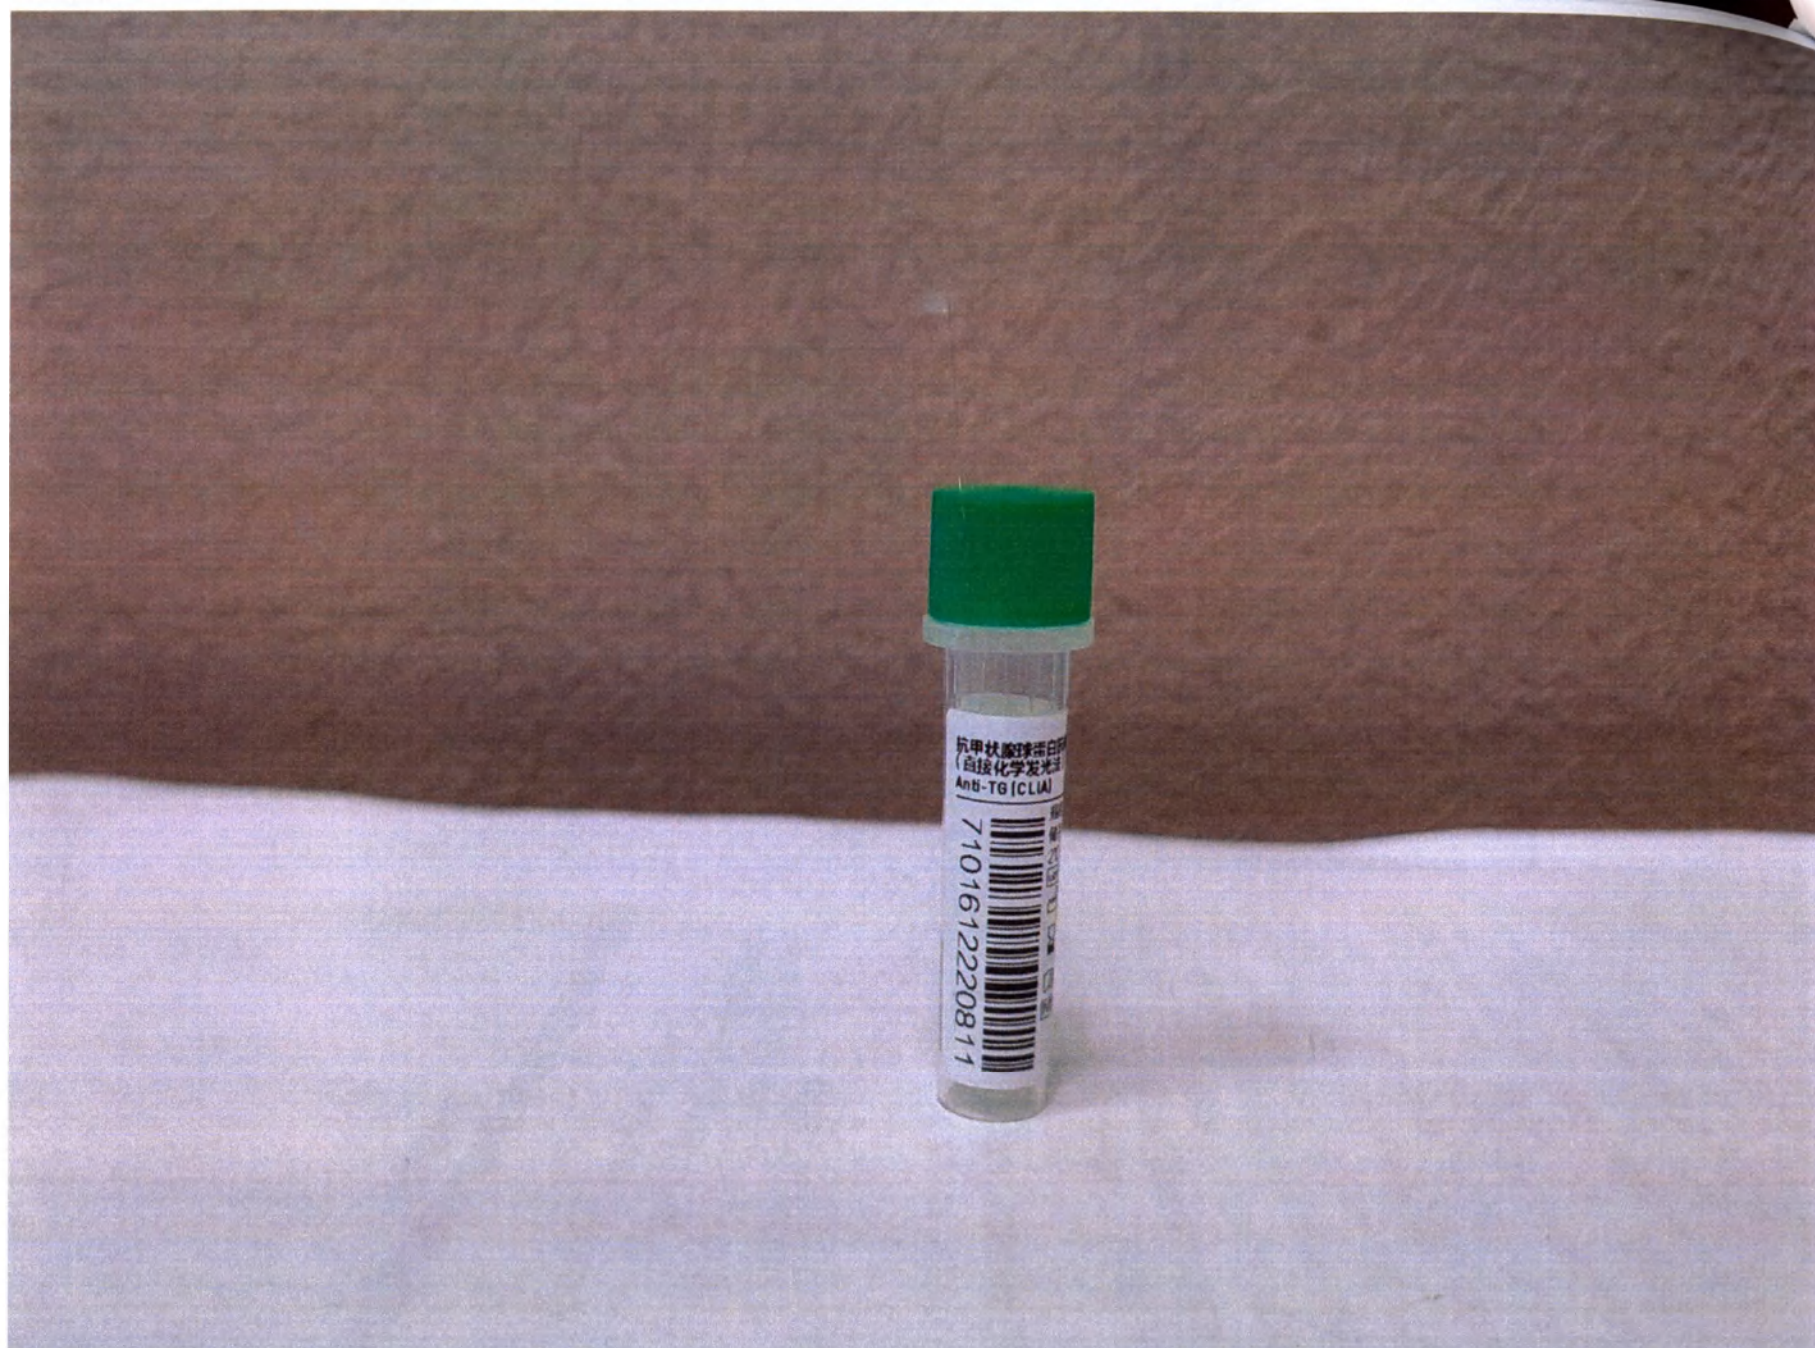

Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-TГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1




Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

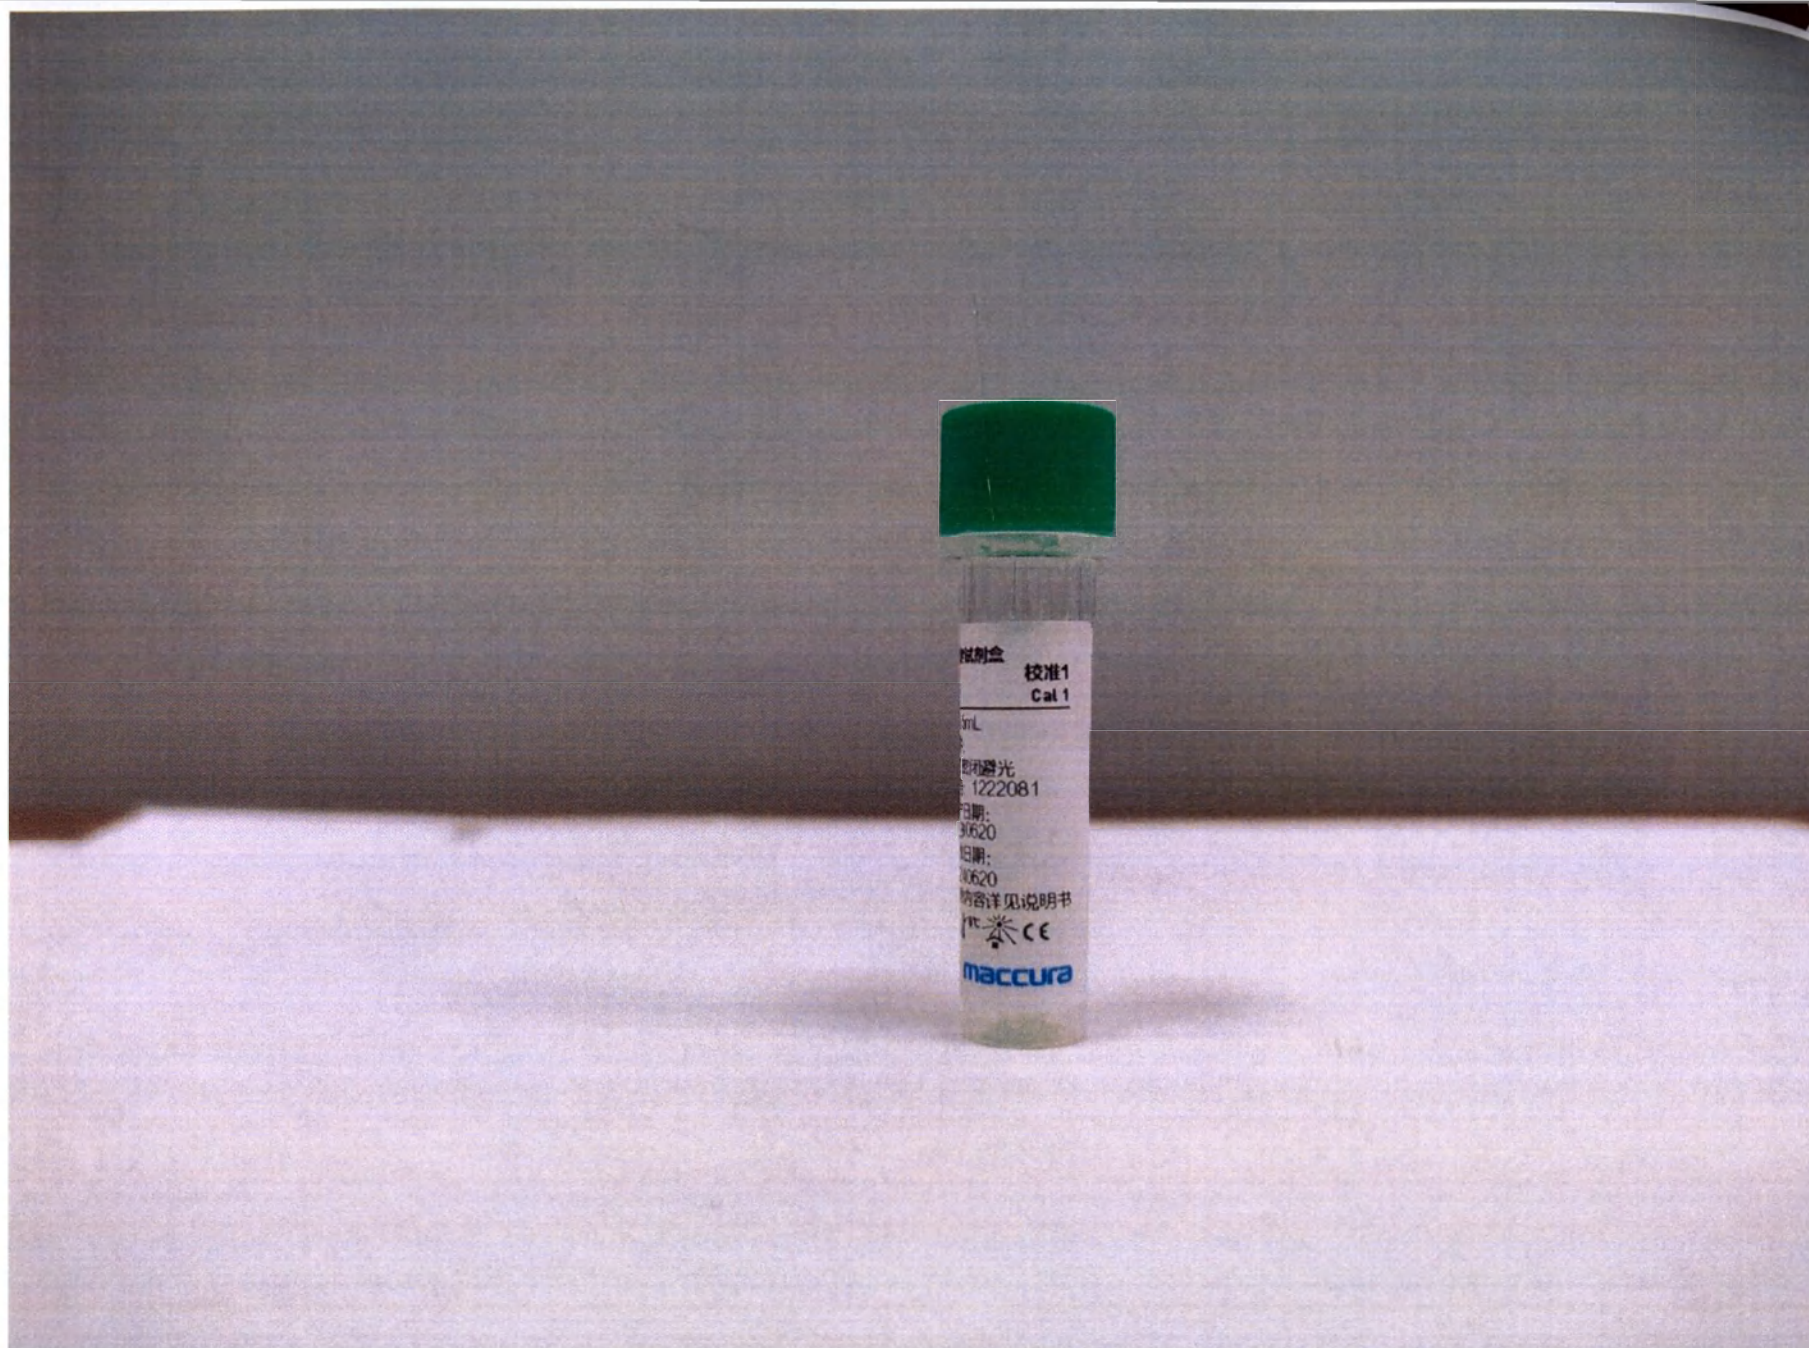

Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3



Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура і (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов»,сторона 1

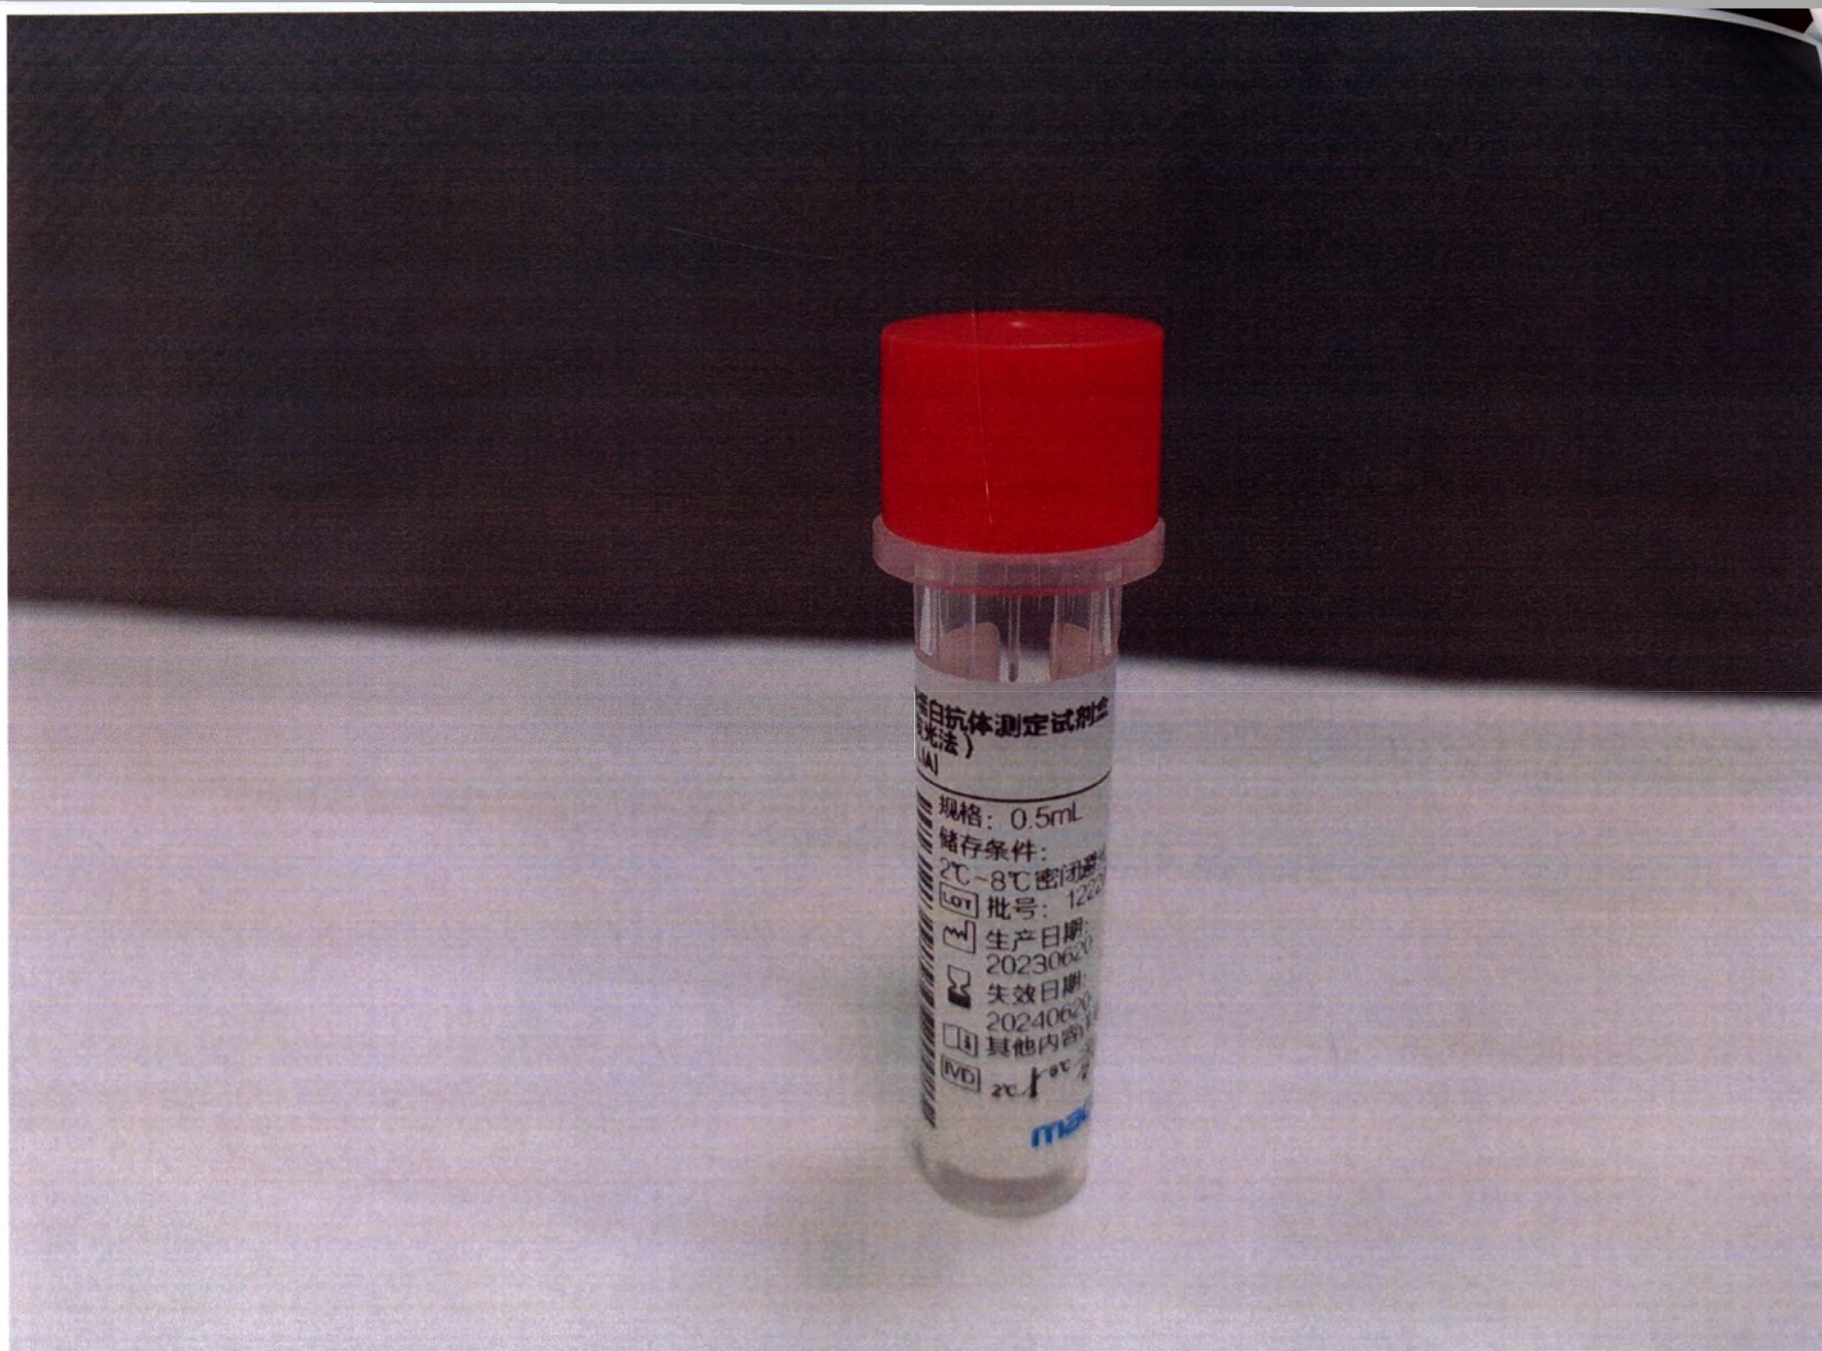

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2



Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3



Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура і (Anti-TG (CLIA)), набор на 200 тестов»



Фото транспортной упаковки

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16 листов

Р.К. Мелконьянц
Директор ООО «Эвопром»

