


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор контрольных материалов для контроля качества определения
общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (25-
ОН Vitamin D Control), в вариантах исполнения**

**производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan
Road,Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China**

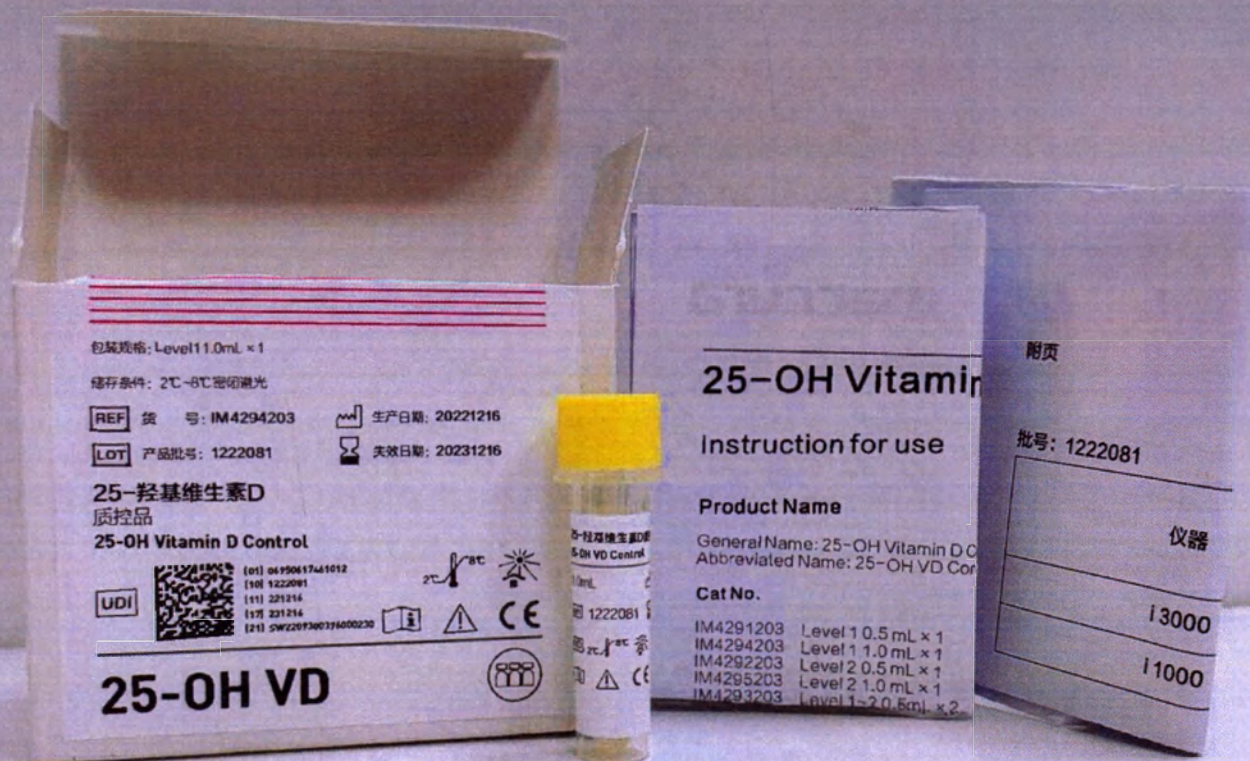

Общий вид медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (25-ОН Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 1»




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Massura i (25-ОН Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид спереди.



Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (25-ОН Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид сверху.



Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (25-ОН Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид сбоку.

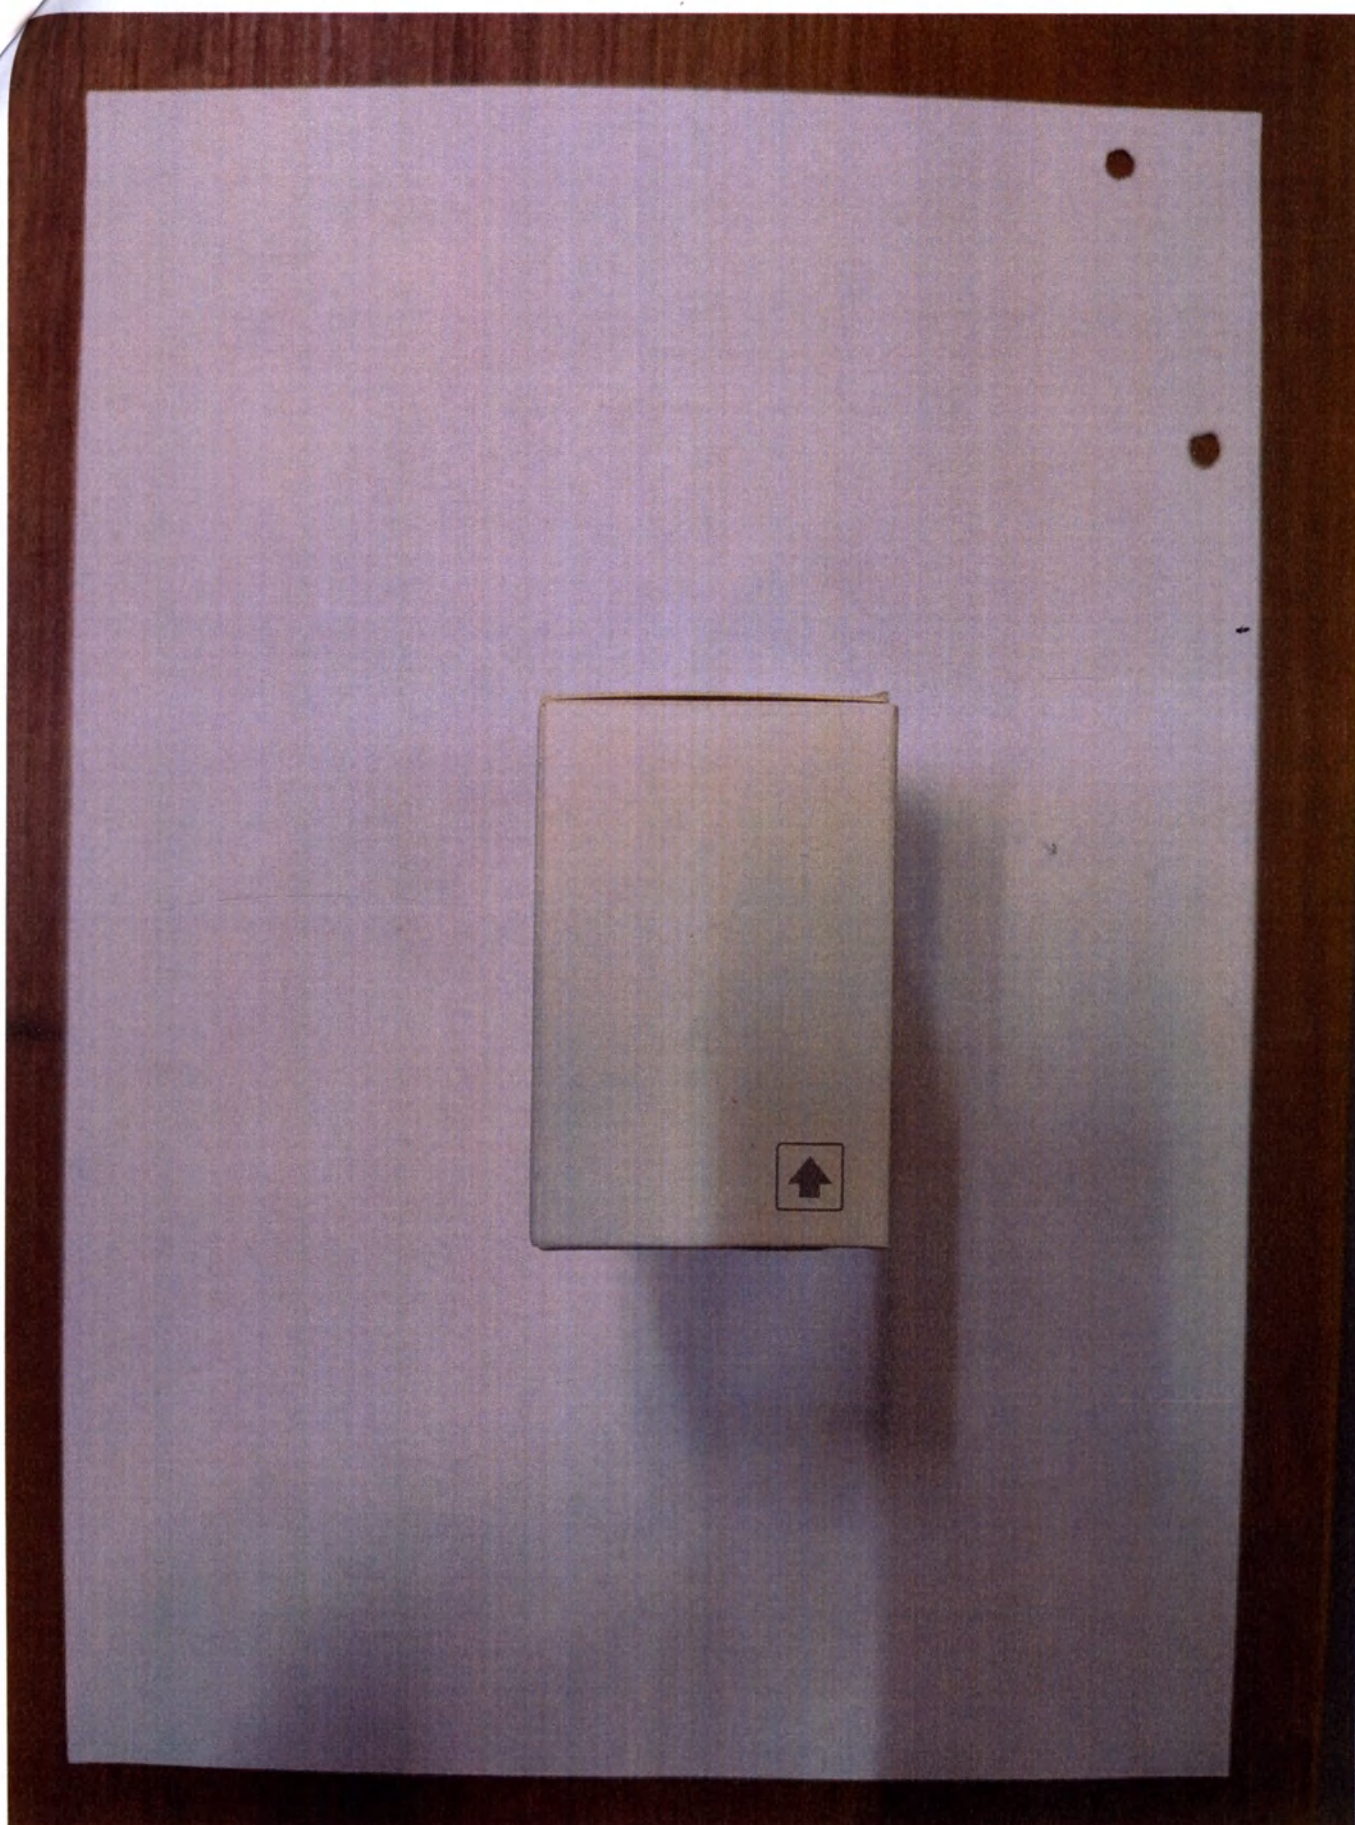

Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (25-ОН Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид сбоку.

迈克生物股份有限公司
住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号
电话: +86 28 8782 6777
传真: +86 28 8782 5783
邮编: 611731
邮箱: maccura@maccura.com




Maccura Biotechnology Co., Ltd.
Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731
Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86 28 8782 6777
Fax: +86 28 8782 5783
E-mail: maccura@maccura.com


www.maccura.com




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Мaccura i (25-ОН Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид сзади.

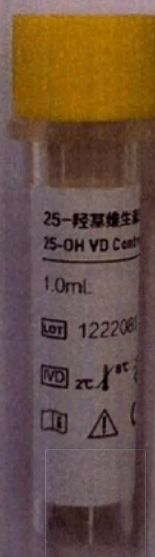

Пробирка содержащая «Материал контрольный 1 (25-OH VD - Level 1)» - сторона 1.

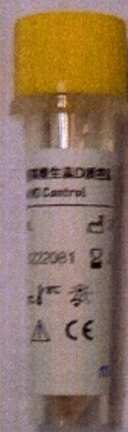

Пробирка содержащая «Материал контрольный 1 (25-OH VD - Level 1)» - сторона 2.

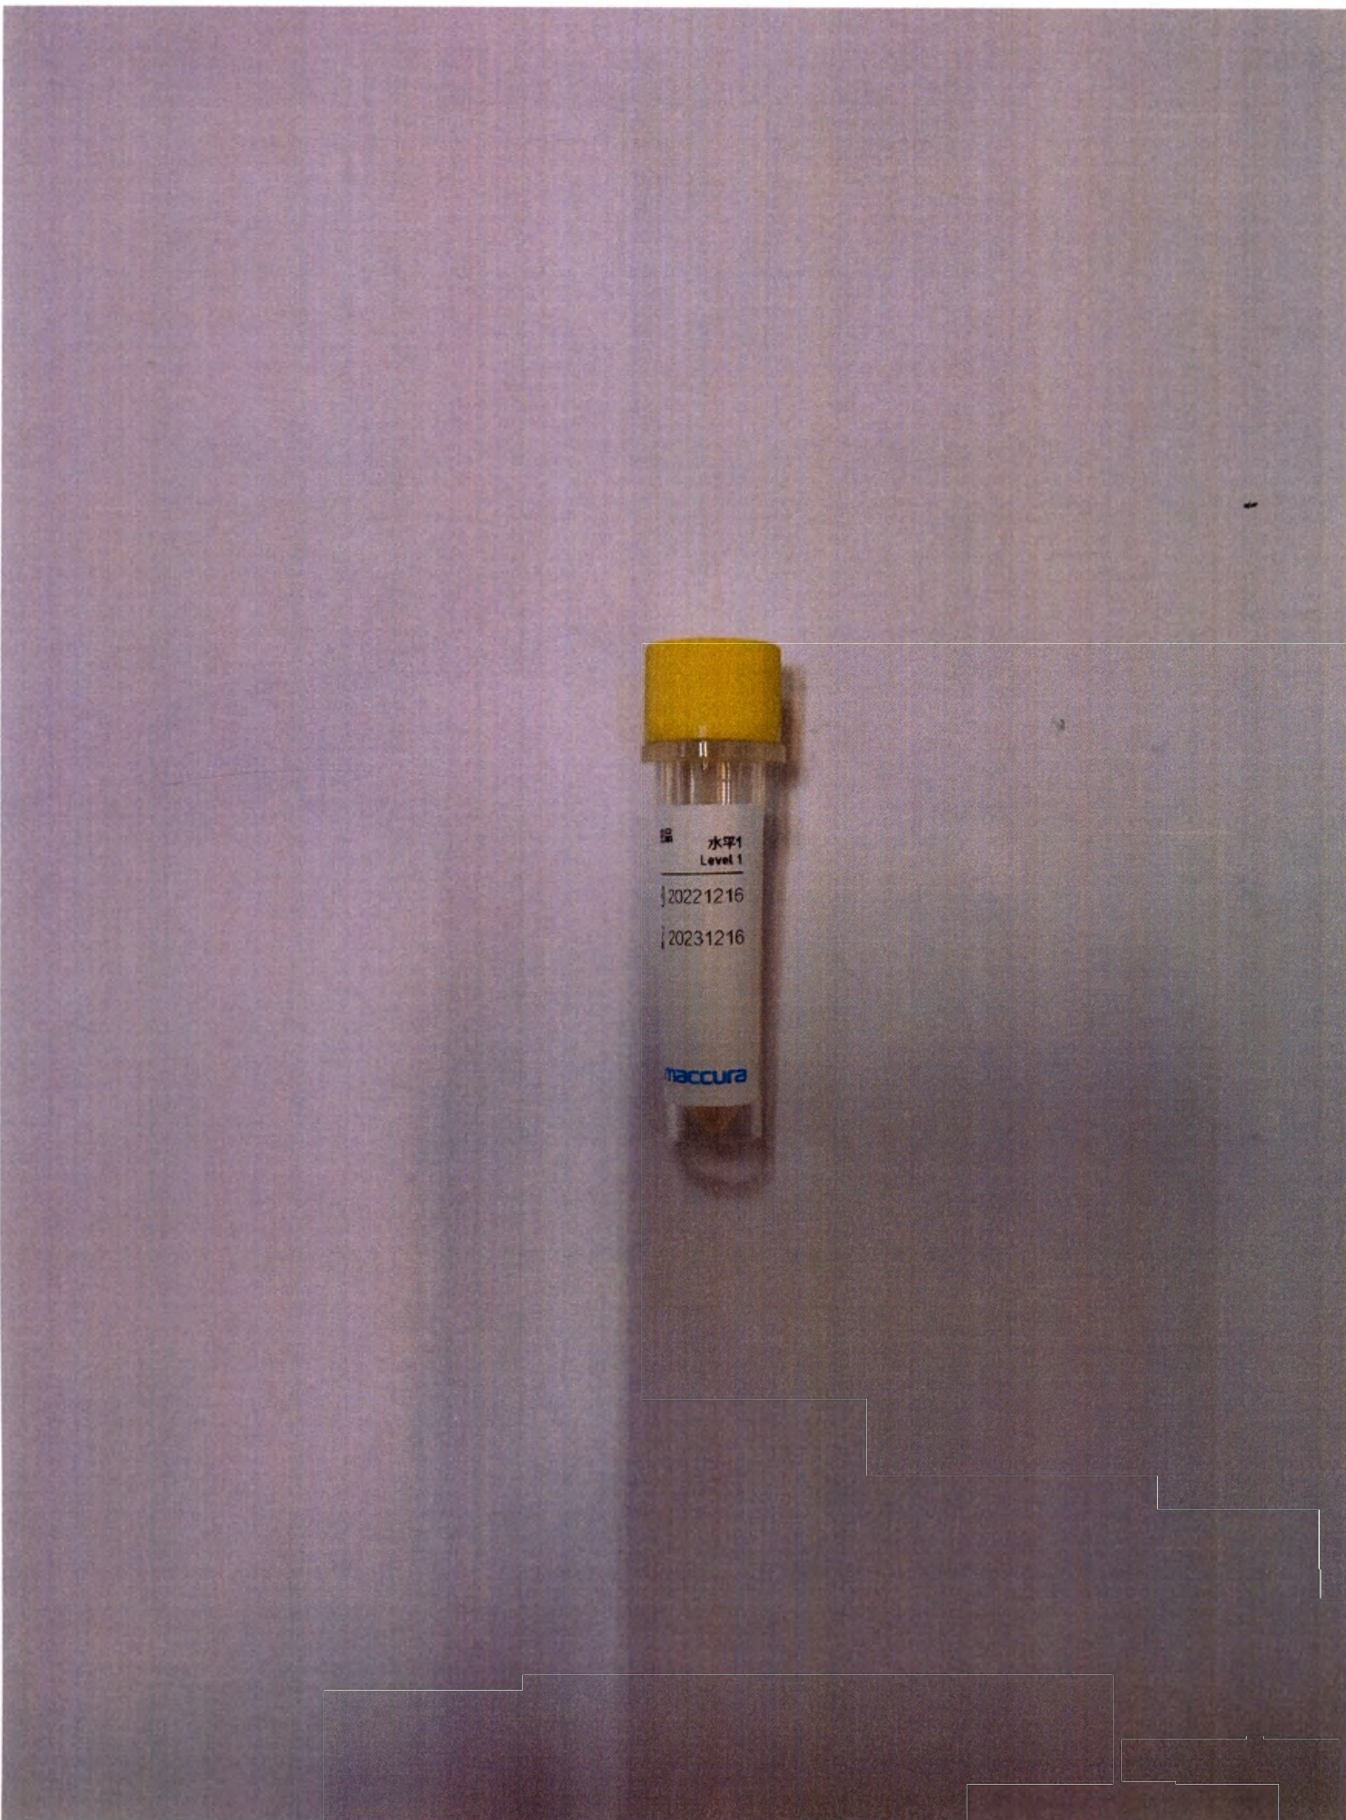

Пробирка содержащая «Материал контрольный 1 (25-OH VD - Level 1)» - сторона 3.



Общий вид медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-OH витамин D) в люминесцентным методом на анализаторах Maccura i (25-OH Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 2»




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Masscura i (25-OH Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид спереди.



Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (25-ОН Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид сверху.



Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (25-ОН Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид сбоку.

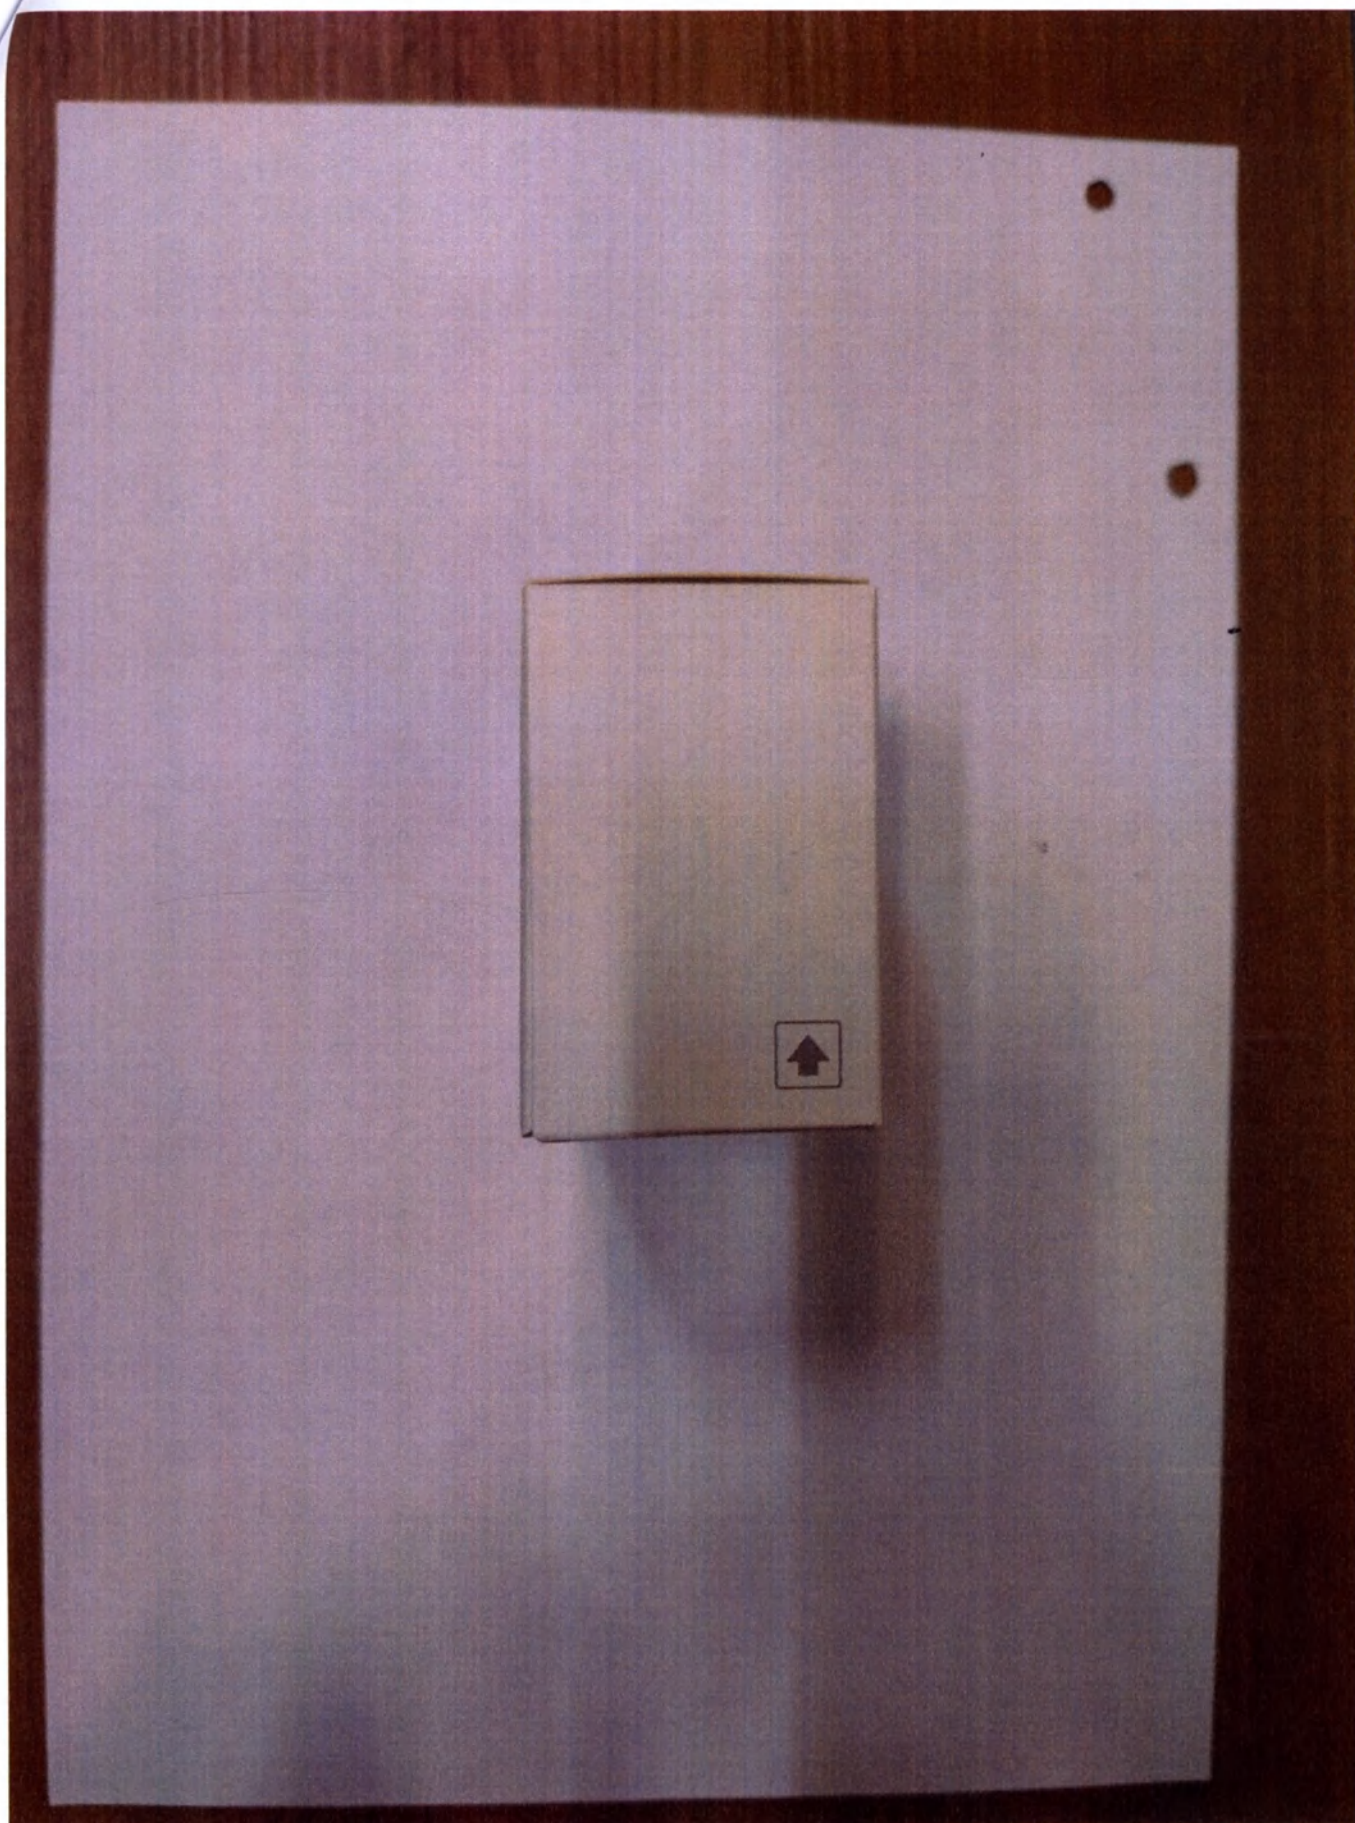

Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-OH витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (25-OH Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид сбоку.

迈克生物股份有限公司
住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号
电话: +86 28 8782 6777
传真: +86 28 8782 5783
邮编: 611731
邮箱: maccura@maccura.com




Maccura Biotechnology Co., Ltd.
Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731
Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86 28 8782 6777
Fax: +86 28 8782 5783
E-mail: maccura@maccura.com


www.maccura.com




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-OH витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (25-OH Vitamin D Control), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид сзади.

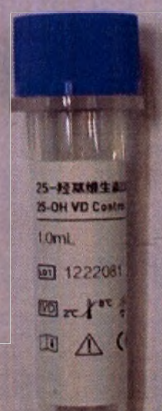

Пробирка содержащая «Материал контрольный 2 (25-OH VD - Level 2)» - сторона 1.

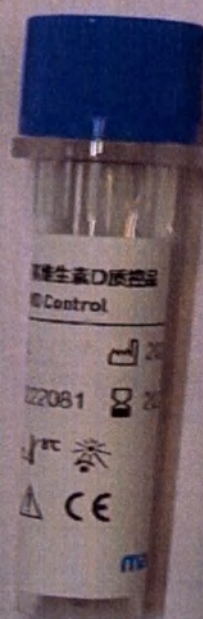

Пробирка содержащая «Материал контрольный 2 (25-OH VD - Level 2)» - сторона 2.

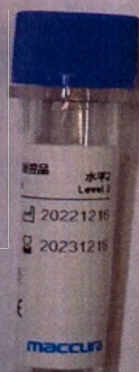

Пробирка содержащая «Материал контрольный 2 (25-OH VD - Level 2)» - сторона 3.



Фото транспортной упаковки

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 20 листов

Р.К. Мелконьянц
Директор ООО «Эвопром»

