

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Монитор пациента многопараметрический в вариантах исполнения: N10,
N10Mpro, N12, N12Mpro, N15, N15Mpro»**


Генеральный директор
ООО «Медстратегия»

Кизилова А.М.



ФОТО ОБЩЕГО ВИДА ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

Монитор пациента многопараметрический N10

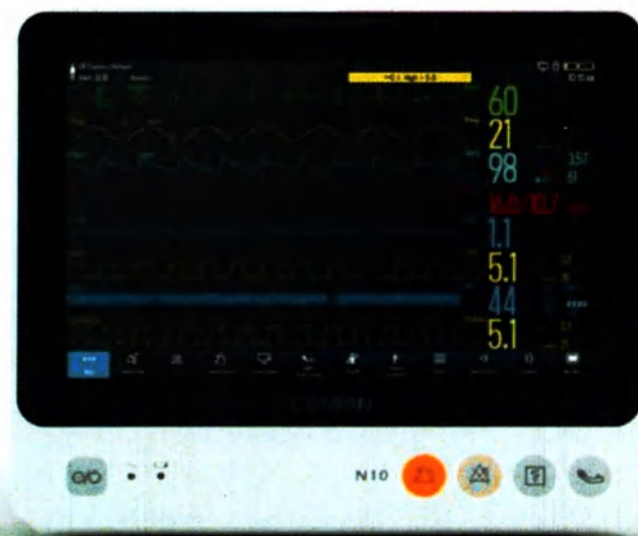

Монитор пациента многопараметрический N10Mpro



Монитор пациента многопараметрический N12



Монитор пациента многопараметрический N12Mpro



Монитор пациента многопараметрический N15




Монитор пациента многопараметрический N15Mpro



МАРКИРОВКА

Пример маркировки варианта исполнения N10

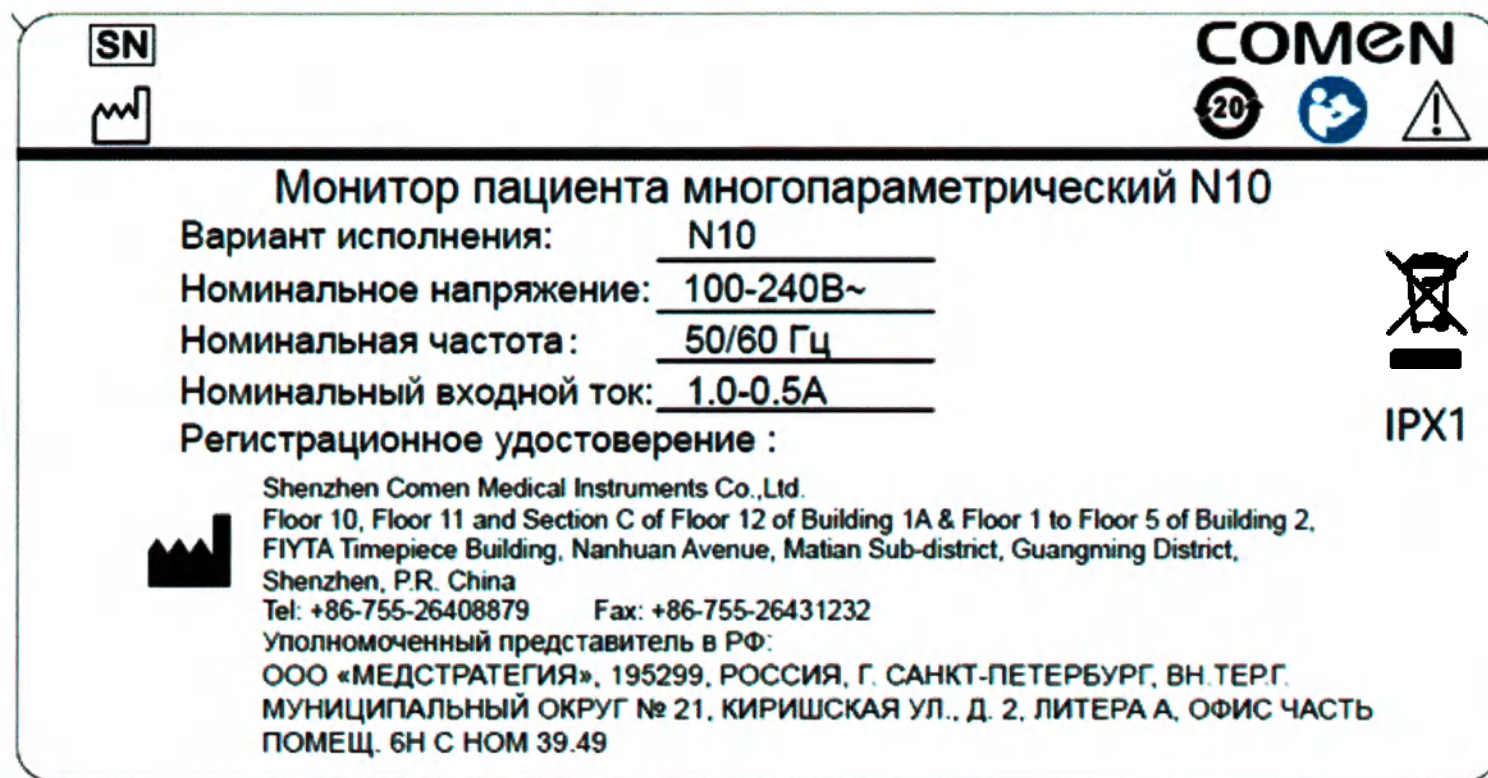

Пример маркировки транспортной упаковки варианта исполнения N10

COMEN

Монитор пациента многопараметрический N10

Размер упаковки: 420мм (длина)х 378мм (глубина) х350мм (высота)

Масса нетто:3.65кг Масса брутто: 6.55кг Количество в упаковке: 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)




Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2,
FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District,
Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.


ИН С НОМ 39.49



THIS WAY UP




FRAGILE




STACKING
LIMITS



KEEP AWAY
FROM RAIN



TEMPERATURE
LIMITS



HUMIDITY
LIMITATION



ATMOSPHERIC
PRESSURE LIMITATION

Пример маркировки варианта исполнения N10Mpro

	COMEN
	  
Монитор пациента многопараметрический N10Mpro	
Вариант исполнения:	<u>N10Mpro</u>
Номинальное напряжение:	<u>100-240В~</u>
Номинальная частота:	<u>50/60 Гц</u>
Номинальный входной ток:	<u>1.0-0.5А</u>
Регистрационное удостоверение :	 IPX1
	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd. Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China Tel: +86-755-26408879 Fax: +86-755-26431232 Уполномоченный представитель в РФ: ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2, ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49

Пример маркировки транспортной упаковки варианта исполнения N10Mpro

COMEN

Монитор пациента многопараметрический N10Mpro

Размер упаковки: 420мм (длина)х 378мм (глубина) х350мм (высота)

Масса нетто:3.45кг Масса брутто: 7.05кг Количество в упаковке: 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)




Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2,
FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District,
Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.
6Н С НОМ 39.49



THIS WAY UP




FRAGILE




STACKING
LIMITS




KEEP AWAY
FROM RAIN



TEMPERATURE
LIMITS



HUMIDITY
LIMITATION



ATMOSPHERIC
PRESSURE LIMITATION

Пример маркировки варианта исполнения N12

	
	  
Монитор пациента многопараметрический N12	
Вариант исполнения:	<u>N12</u>
Номинальное напряжение:	<u>100-240В~</u>
Номинальная частота:	<u>50/60 Гц</u>
Номинальный входной ток:	<u>1.0-0.5А</u>
Регистрационное удостоверение :	 IPX1
	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd. Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China Tel: +86-755-26408879 Fax: +86-755-26431232 Уполномоченный представитель в РФ: ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2, ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49

Пример маркировки транспортной упаковки варианта исполнения N12

COMEN

Монитор пациента многопараметрический N12

Размер упаковки: 425мм (длина)х 420мм (глубина) х380мм (высота)

Масса нетто:3.3кг Масса брутто: 6.65кг Количество в упаковке: 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)




Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2,
FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District,
Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:


ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.

6Н С НОМ 39.49



THIS WAY UP




FRAGILE




STACKING
LIMITS




KEEP AWAY
FROM RAIN



TEMPERATURE
LIMITS



HUMIDITY
LIMITATION



ATMOSPHERIC
PRESSURE LIMITATION

Пример маркировки варианта исполнения N12Mpro

SN		COMEN	
		  	
Монитор пациента многопараметрический N12Mpro			
Вариант исполнения:	<u>N12Mpro</u>	 IPX1	
Номинальное напряжение:	<u>100-240В~</u>		
Номинальная частота:	<u>50/60 Гц</u>		
Номинальный входной ток:	<u>1.0-0.5A</u>		
Регистрационное удостоверение :			
	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd. Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China		
	Tel: +86-755-26408879 Fax: +86-755-26431232		
	Уполномоченный представитель в РФ: ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2, ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49		

Пример маркировки транспортной упаковки варианта исполнения N12Mpro

COMEN

Монитор пациента многопараметрический N12Mpro

Размер упаковки: 425мм (длина)х 420мм (глубина) х380мм (высота)

Масса нетто:3.8кг Масса брутто: 8.55кг Количество в упаковке: 1 шт.






Регистрационное удостоверение № _____ от _____

 Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2,
FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District,
Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.
6Н С НОМ 39.49



Пример маркировки варианта исполнения N15

		COMEN	
		  	
Монитор пациента многопараметрический N15			
Вариант исполнения:	<u>N15</u>	 IPX1	
Номинальное напряжение:	<u>100-240В~</u>		
Номинальная частота:	<u>50/60 Гц</u>		
Номинальный входной ток:	<u>1.5-0.75А</u>		
Регистрационное удостоверение :			
	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd. Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China		
	Tel: +86-755-26408879 Fax: +86-755-26431232 Уполномоченный представитель в РФ: ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2, ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49		

Пример маркировки транспортной упаковки варианта исполнения N15

COMEN

Монитор пациента многопараметрический N15

Размер упаковки: 505мм (длина)х 430мм (глубина) х430мм (высота)

Масса нетто:4.6кг Масса брутто: 8.9кг Количество в упаковке: 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)




Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2,
FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District,
Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.


Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.
6Н С НОМ 39.49



THIS WAY UP




FRAGILE




STACKING
LIMITS




KEEP AWAY
FROM RAIN



TEMPERATURE
LIMITS



HUMIDITY
LIMITATION



ATMOSPHERIC
PRESSURE LIMITATION

Пример маркировки варианта исполнения N15Mpro

	
	  
Монитор пациента многопараметрический N15Mpro	
Вариант исполнения:	<u>N15Mpro</u>
Номинальное напряжение:	<u>100-240В~</u>
Номинальная частота:	<u>50/60 Гц</u>
Номинальный входной ток:	<u>1.5-0.75А</u>
Регистрационное удостоверение :	 IPX1
	
Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd. Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China Tel: +86-755-26408879 Fax: +86-755-26431232 Уполномоченный представитель в РФ: ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2, ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49	

Пример маркировки транспортной упаковки варианта исполнения N15Mpro

COMEN

Монитор пациента многопараметрический N15Mpro

Размер упаковки: 505мм (длина) x 430мм (глубина) x 430мм (высота)

Масса нетто: 5.05кг Масса брутто: 10.6кг Количество в упаковке: 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.


(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2,
FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District,
Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.


Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.
6Н С НОМ 39.49



THIS WAY UP




FRAGILE




STACKING
LIMITS




KEEP AWAY
FROM RAIN



TEMPERATURE
LIMITS




HUMIDITY
LIMITATION



ATMOSPHERIC
PRESSURE LIMITATION

УПАКОВКА

Пример упаковки монтора

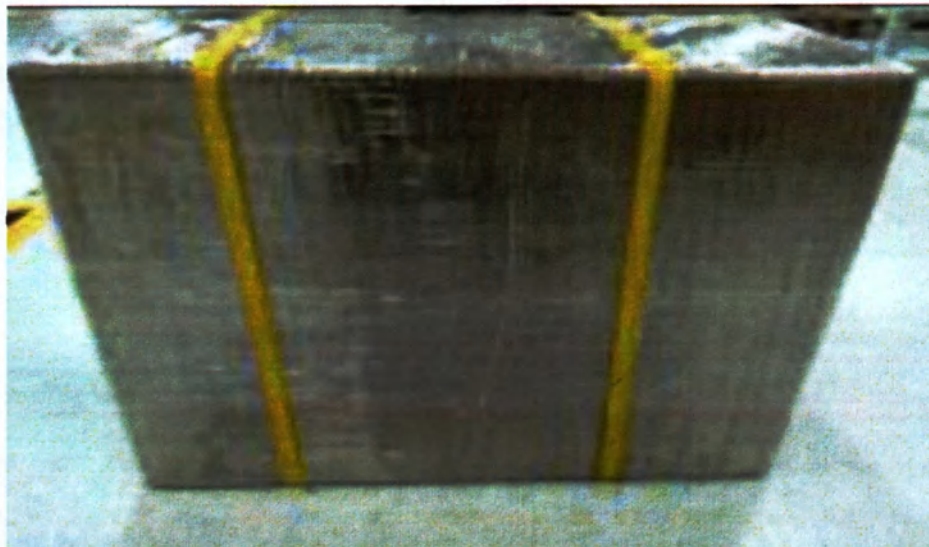


СОСТАВ

Монитор пациента многопараметрический N10 (Основной блок)




Монитор пациента многопараметрический N10Mpro (Основной блок)

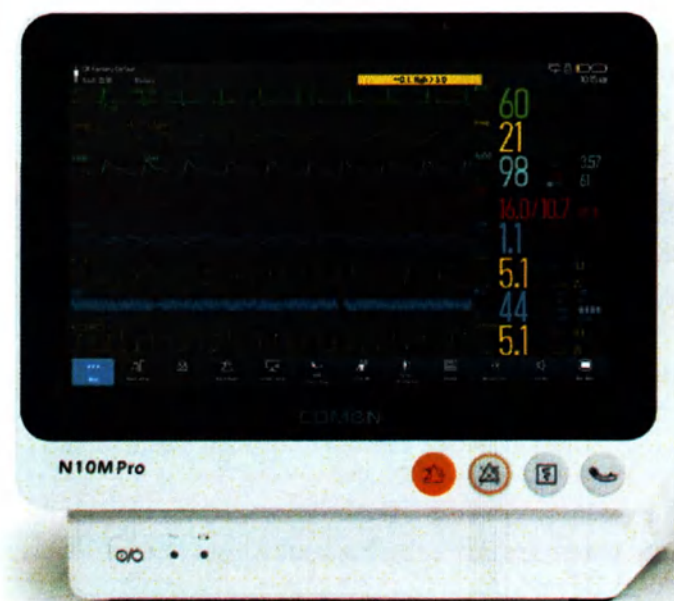


Монитор пациента многопараметрический N12 (Основной блок)



Монитор пациента многопараметрический N12Mpro (Основной блок)

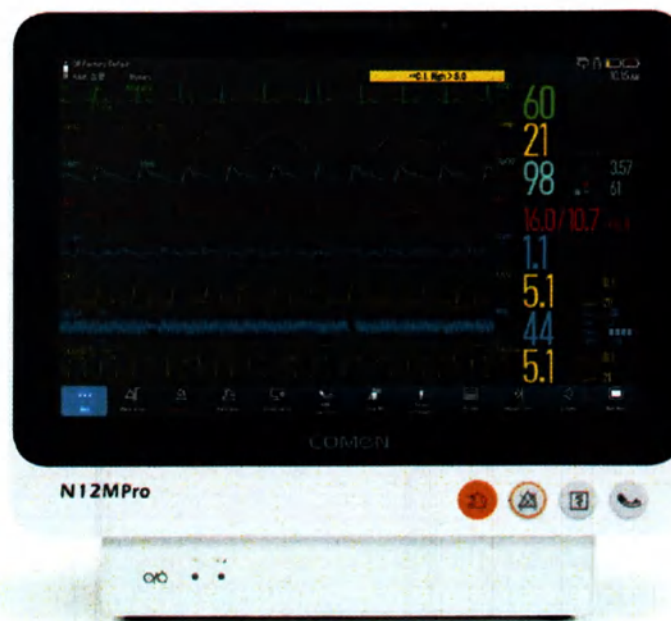

Монитор пациента многопараметрический N15 (Основной блок)

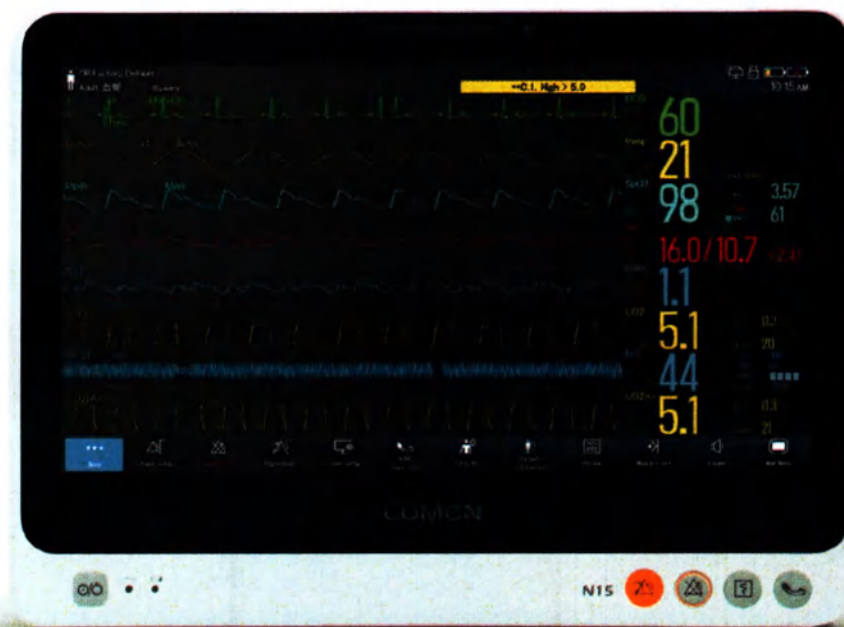

Монитор пациента многопараметрический N15Mpro (Основной блок)



Руководство по эксплуатации (варианты исполнения: N10, N12, N15)

Multi-parameter patient monitor in versions: N10, N10Mpro,
N12, N12Mpro, N15, N15Mpro

Монитор пациента многопараметрический в вариантах
исполнения: N10, N10Mpro, N12, N12Mpro, N15, N15Mpro

Operation manual

Руководство по эксплуатации

Version

N10, N12, N15

Варианты исполнения

N10, N12, N15

Руководство по эксплуатации (варианты исполнения: N10Mpro, N12Mpro, N15Mpro)

Multi-parameter patient monitor in versions: N10, N10Mpro,
N12, N12Mpro, N15, N15Mpro

Монитор пациента многопараметрический в вариантах
исполнения: N10, N10Mpro, N12, N12Mpro, N15, N15Mpro

Operation manual
Руководство по эксплуатации


Version
N10Mpro, N12Mpro, N15Mpro

Варианты исполнения
N10Mpro, N12Mpro, N15Mpro


Кабель питания



Кабель заземления

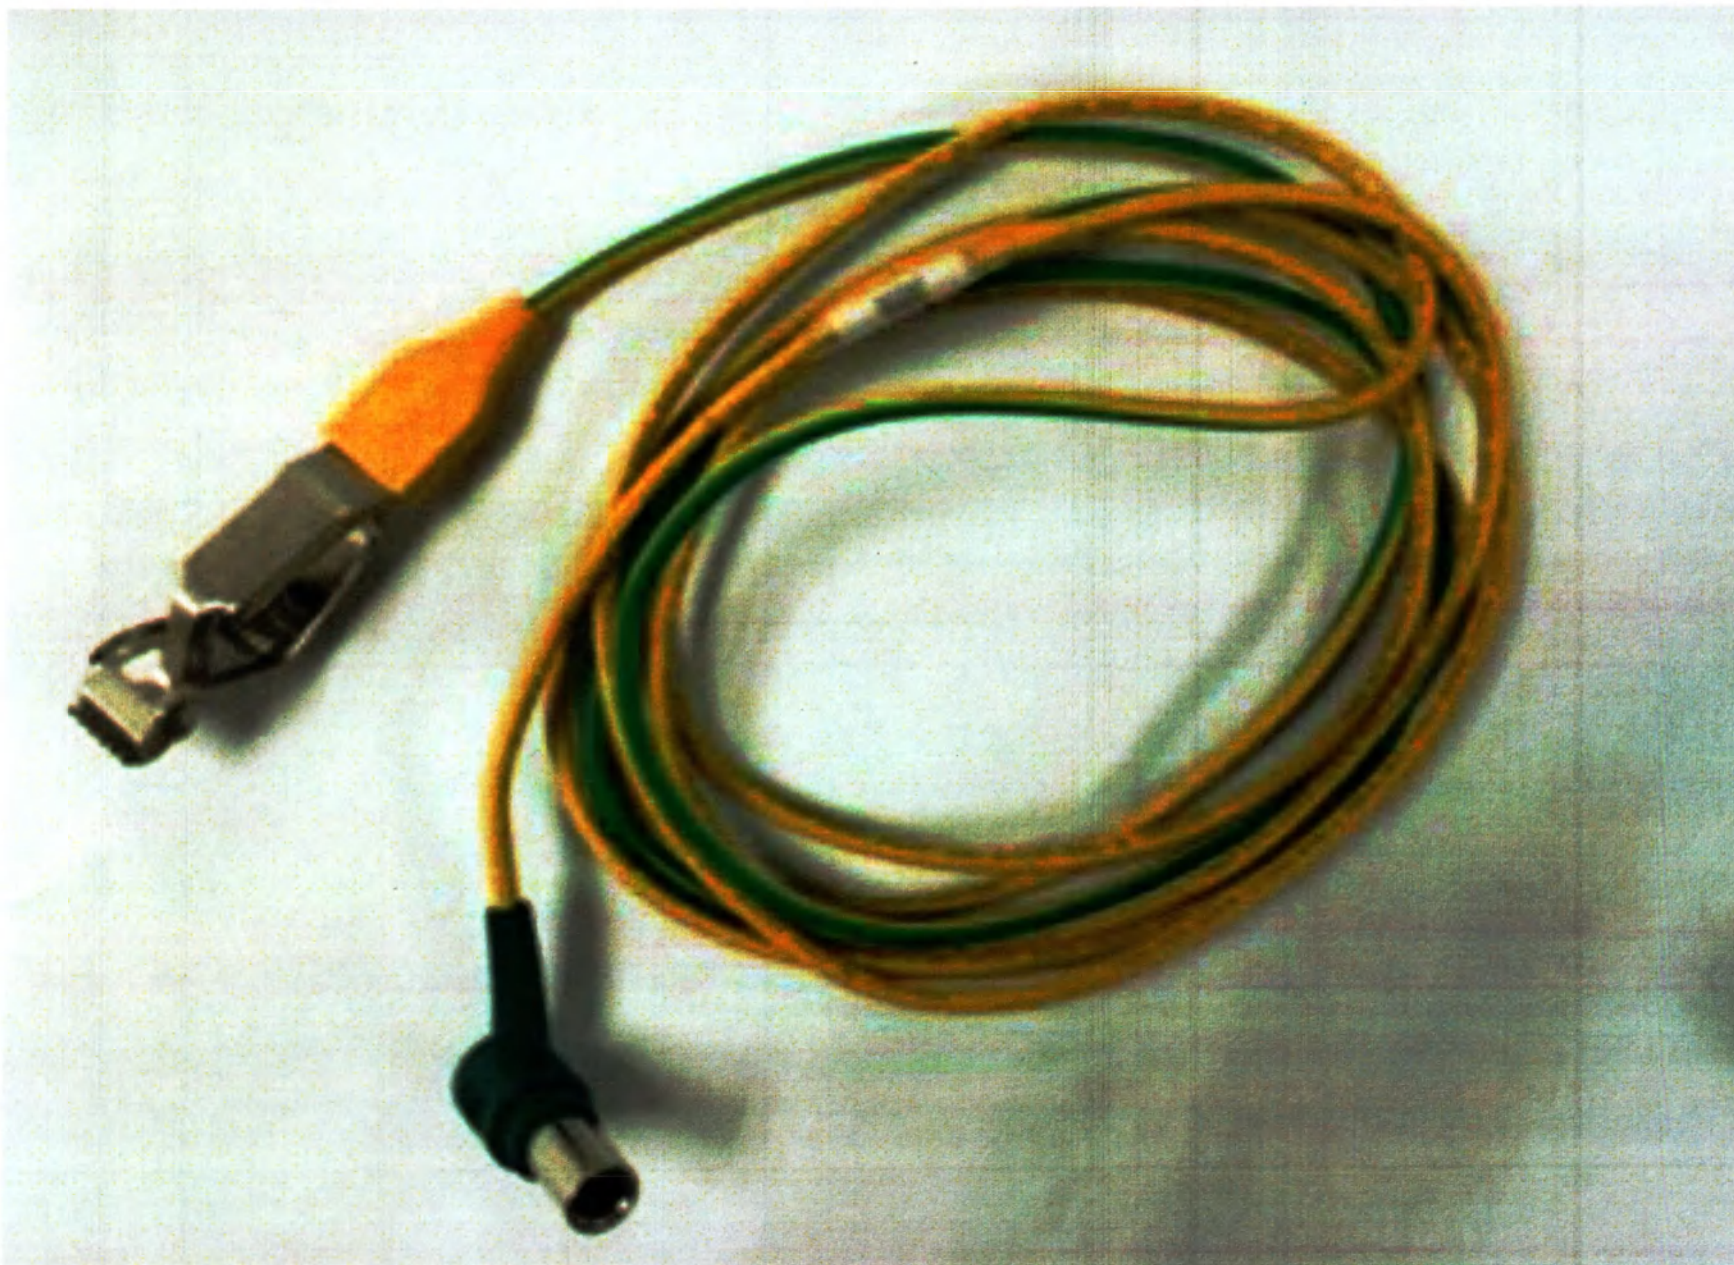

Электроды ЭКГ для новорожденных модель QGD-SF02-37×42

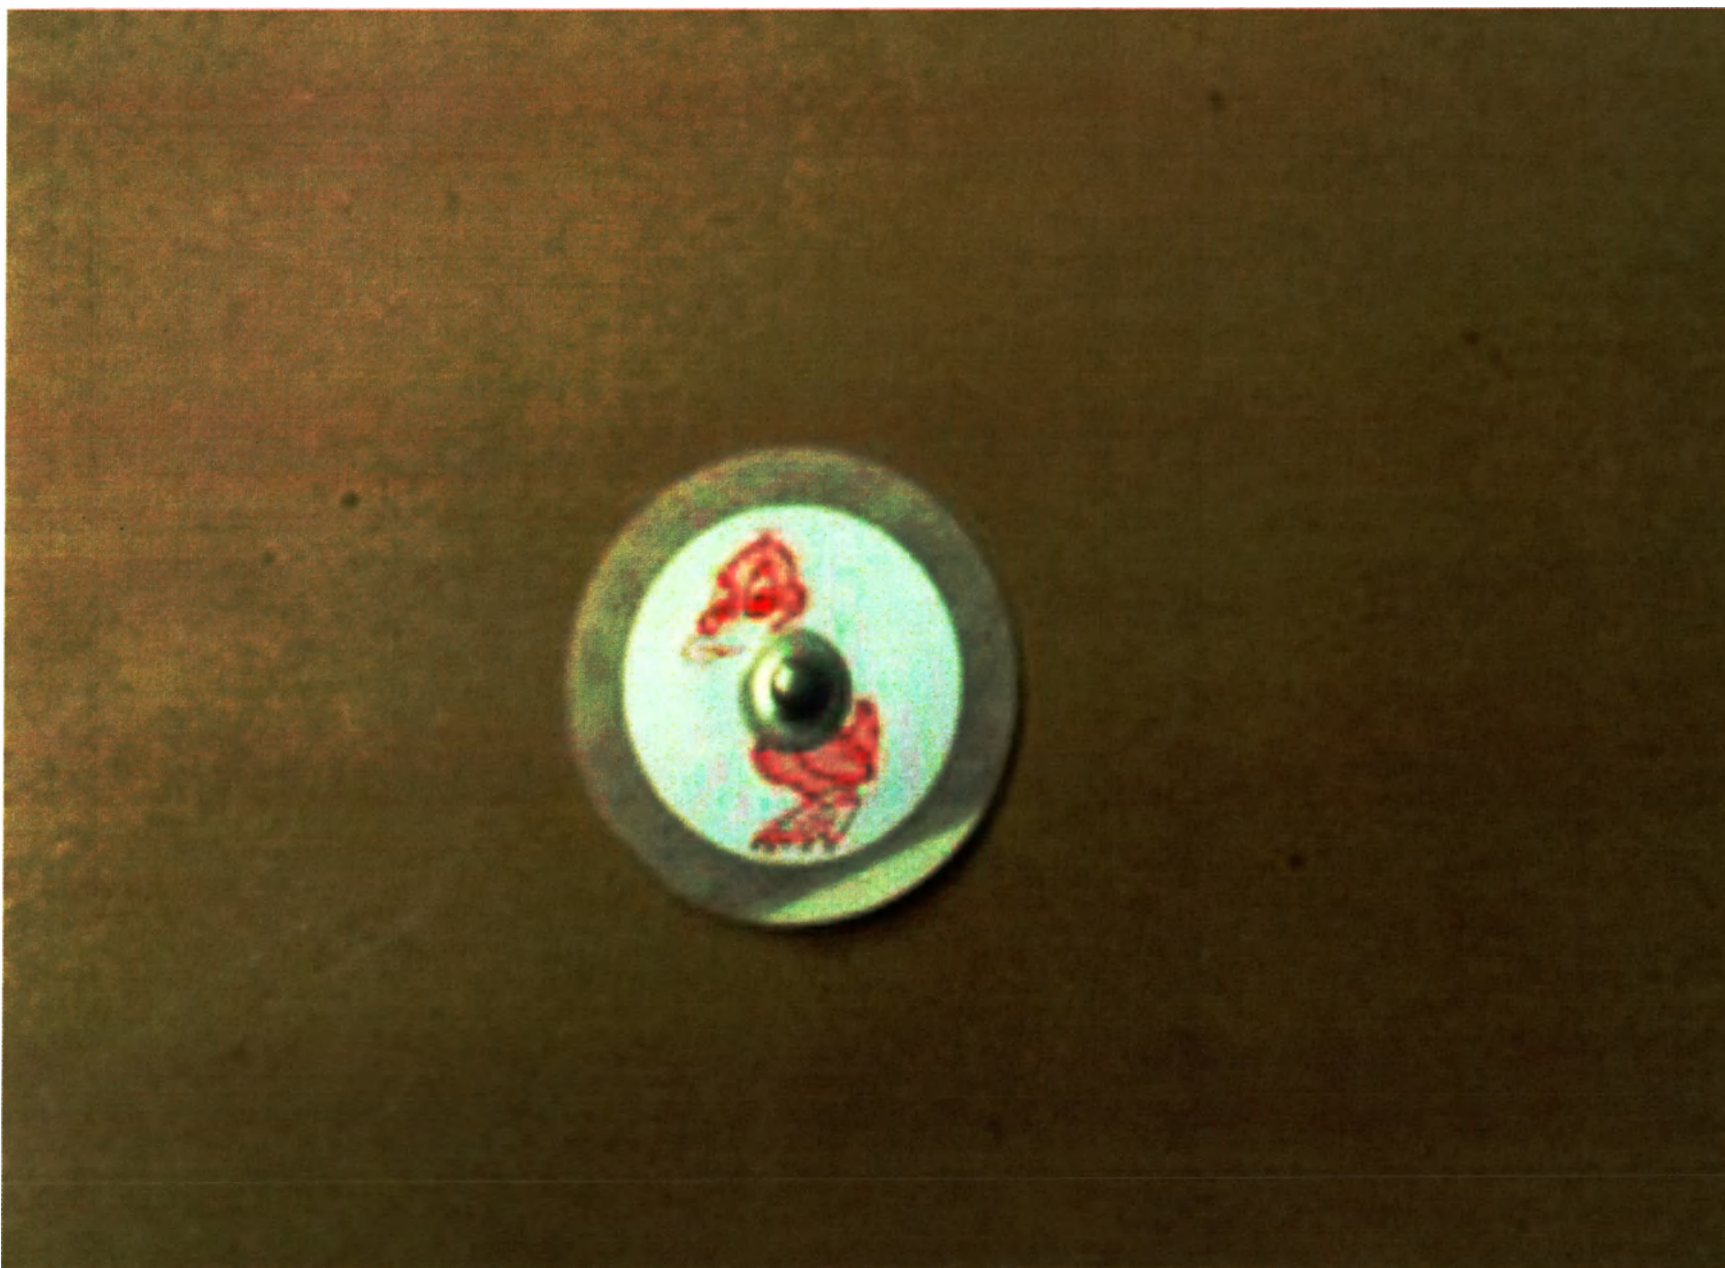


Электроды ЭКГ для взрослых, модель QGD-SF02-42×46




Кабель ЭКГ на 3 отведения, тип клипса



Кабель ЭКГ на 3 отведения, тип прищепка

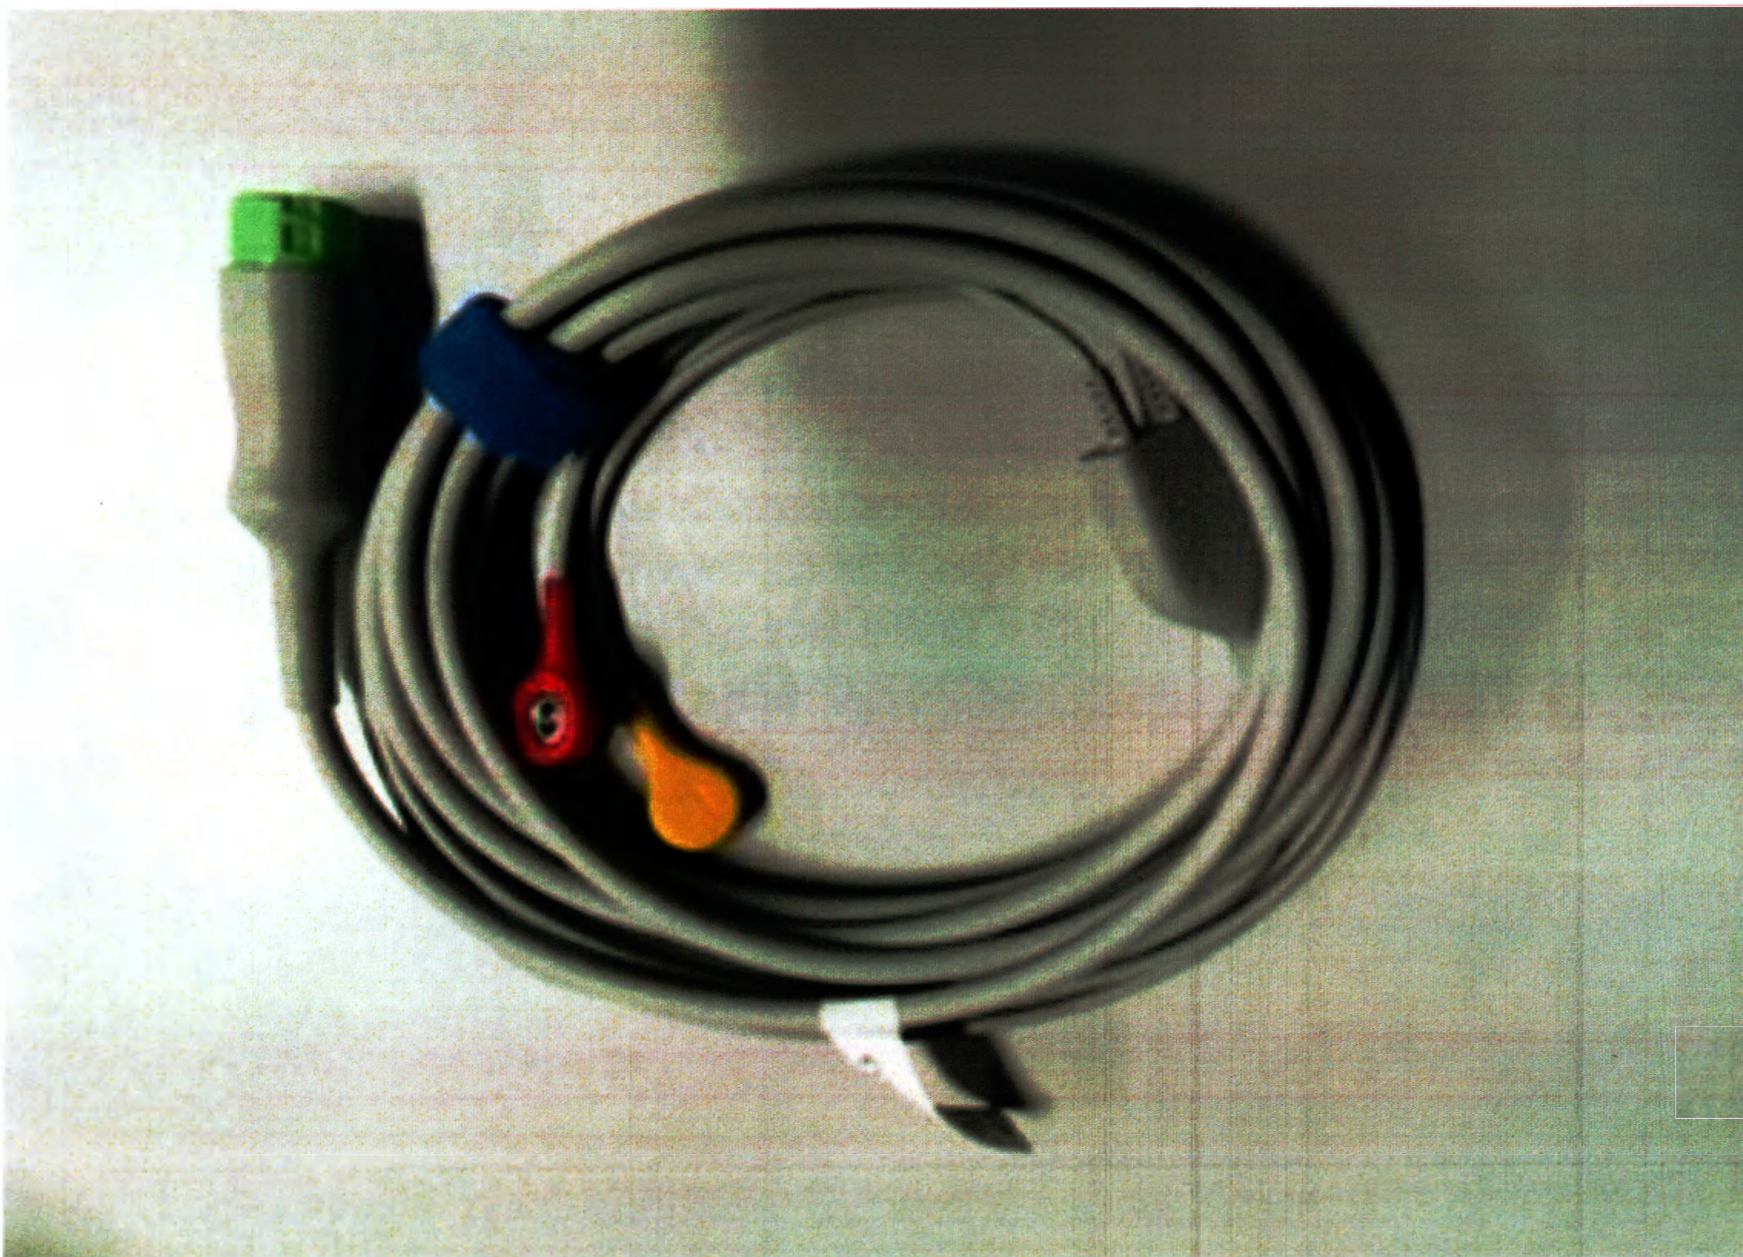

Кабель ЭКГ на 12 отведений, тип клипса

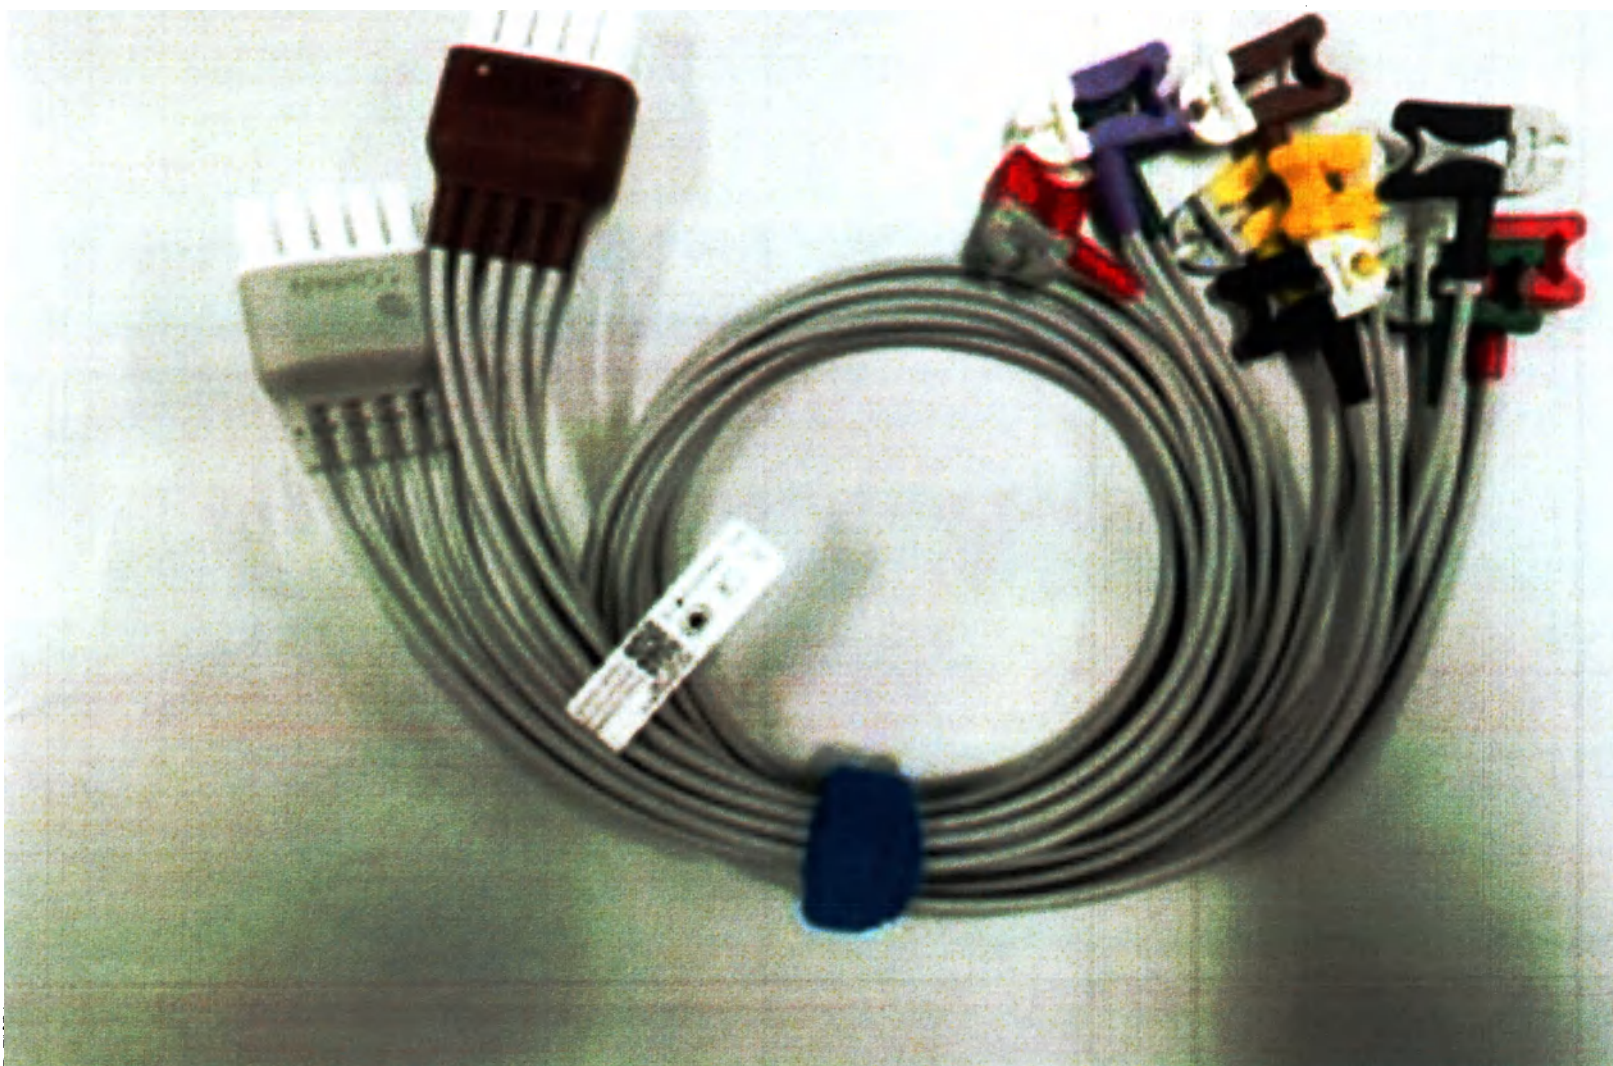

Кабель ЭКГ на 12 отведений, тип прищепка




Кабель ЭКГ на 12 отведений, защита от дефибрилляции




Кабель ЭКГ на 5 отведений, тип клипса



Кабель ЭКГ на 5 отведений, тип прищепка

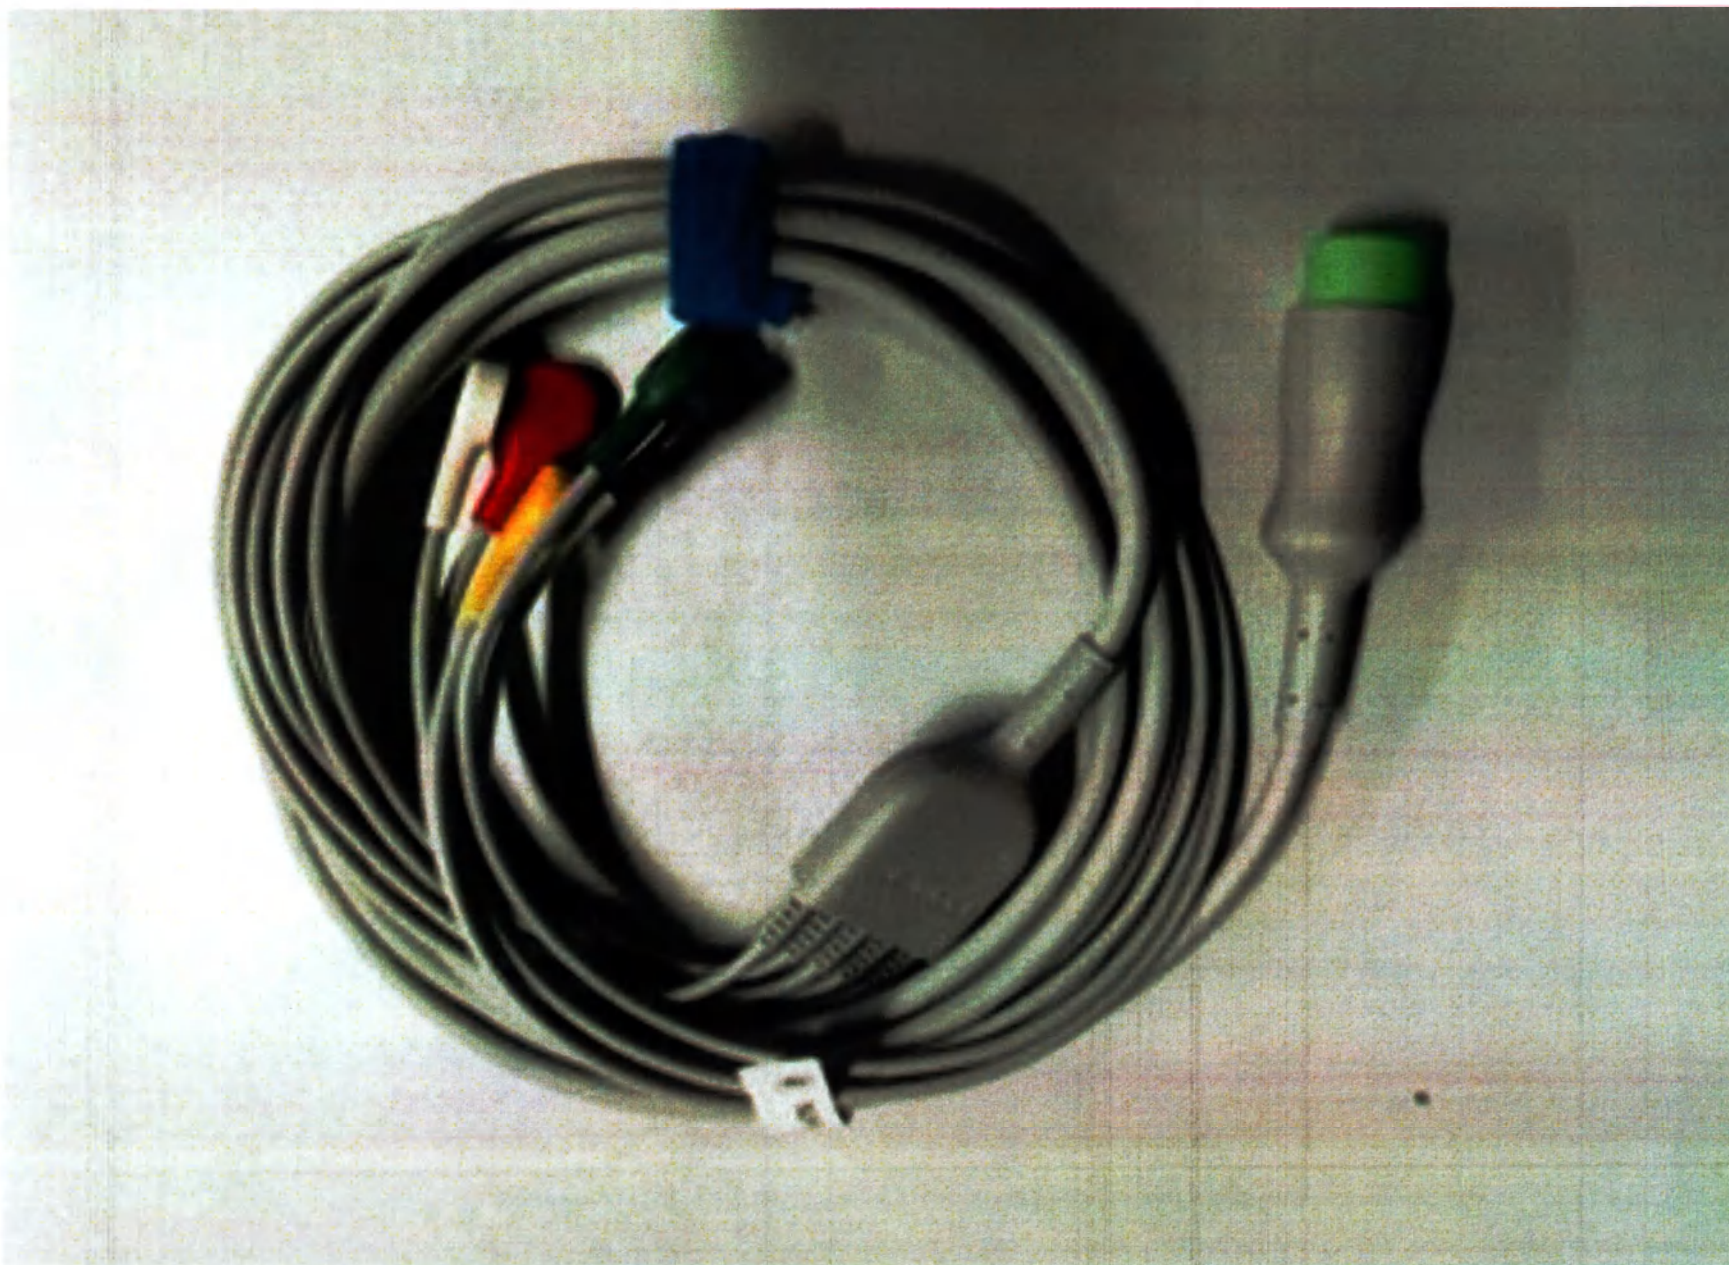

Кабель ЭКГ на 6 отведений, тип клипса

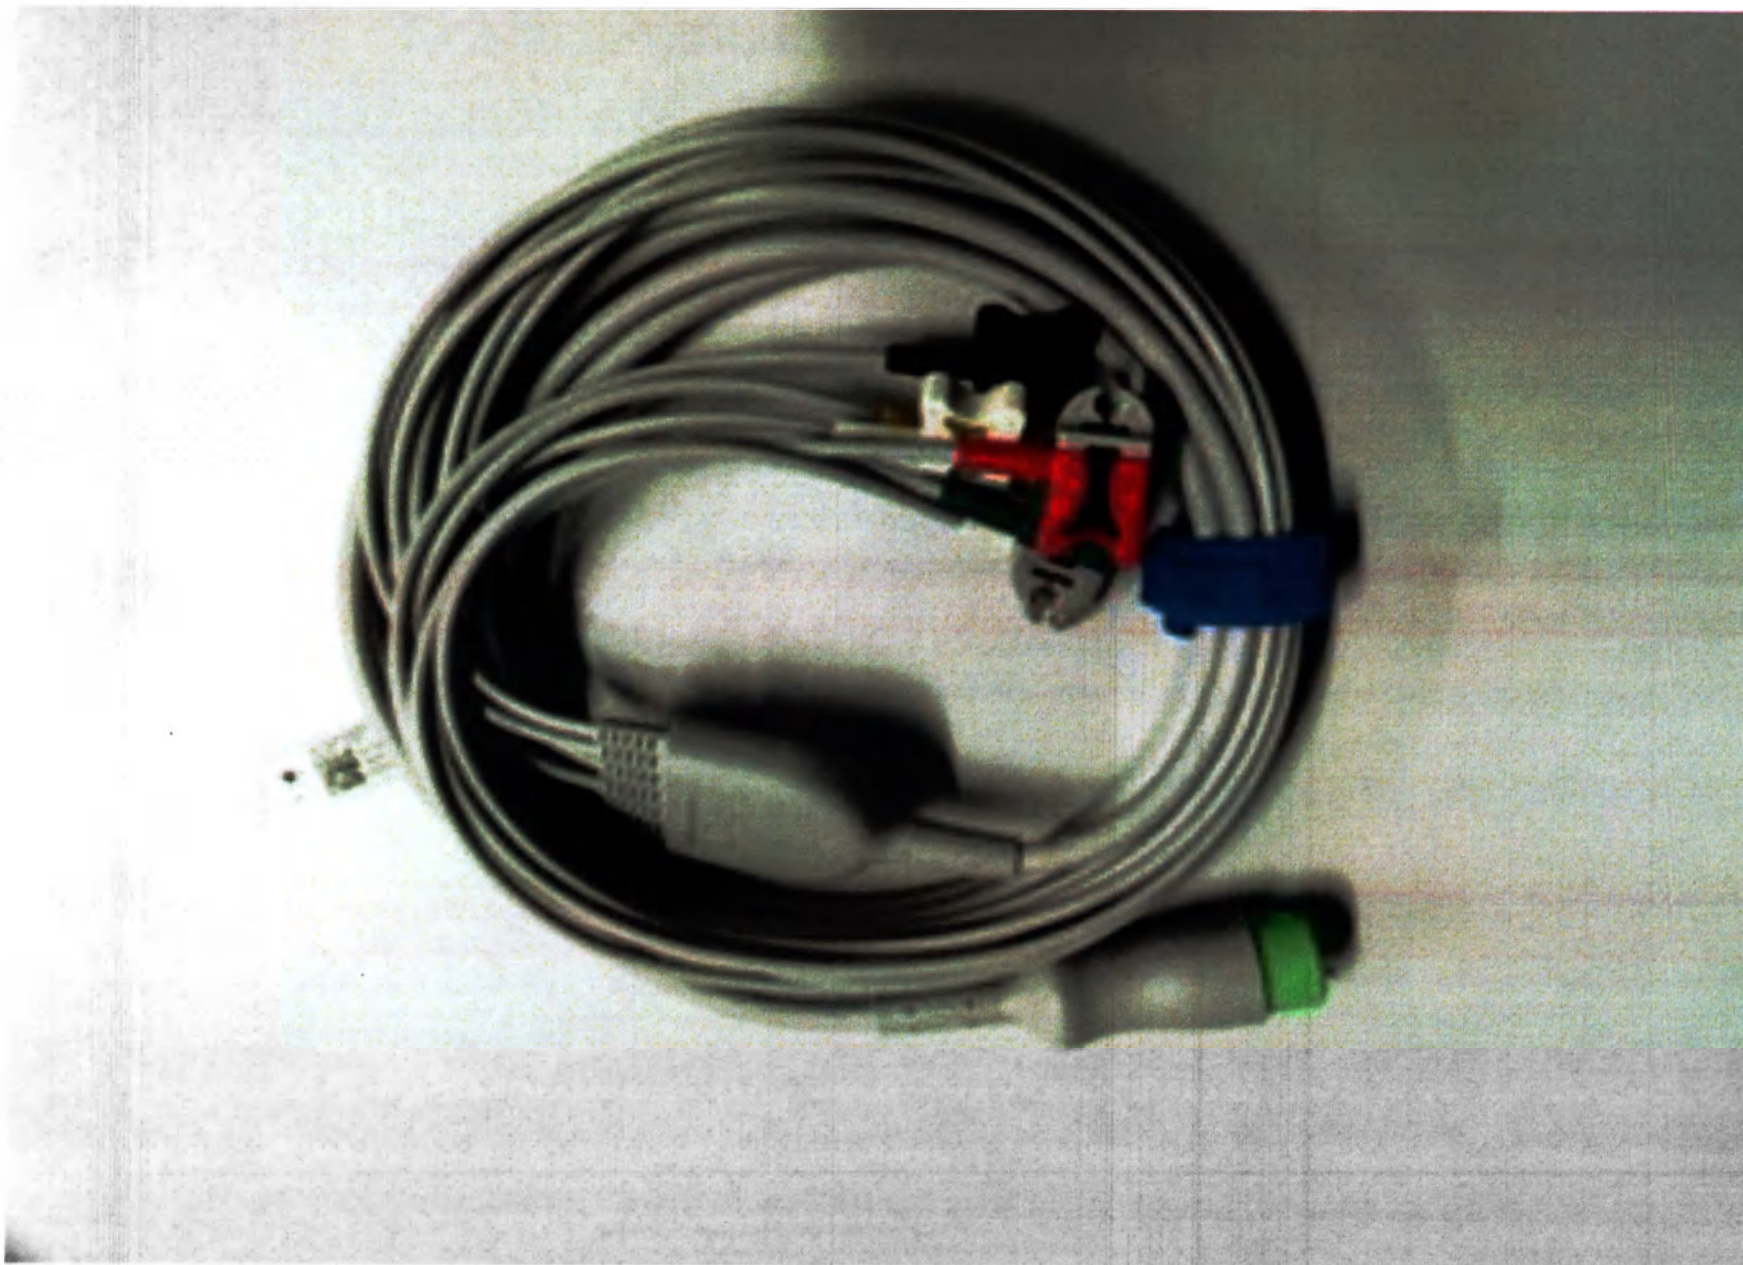

Кабель ЭКГ на 6 отведений, тип прищепка



(040-000869) Многоцветный SpO2 датчик клипса для взрослых, кабель 3.0 м, модель A0816-SA105PV



(040-000312) Многоцветный SpO2 датчик клипса для взрослых, кабель 3.0 м (при необходимости), модель SAL104



Кабель-удлиннитель датчика SpO2, модель SLZ122



Многоразовый SpO2 датчик, клипса, для взрослых, кабель 1.1м, модель SAS104



Многоразовый SpO2 датчик-ремешок, для взрослых/детей/новорожденных, кабель 1.1 м, модель SES104



Многоразовый SpO2 датчик, для детей



Многоцветный SpO2 датчик-ремешок для взрослых/детей/новорожденных



Трубка НИАД 2м



Трубка НИАД 3м



Манжета НИАД / 25-35, модель U1880S



Манжета НИАД / 18-26 см, модель U1881S



Манжета НИАД / 46-66 см), модель U1884S



Манжета НИАД / 20-28 см, модель U1885S



Манжета НИАД / 33-47 см, модель U1869S




Манжета НИАД / 33-47 см, модель U1889S



Манжета НИАД одноразовая / 3 - 6 см, модель U1681S



Манжета НИАД одноразовая /4 - 8 см, модель U1682S

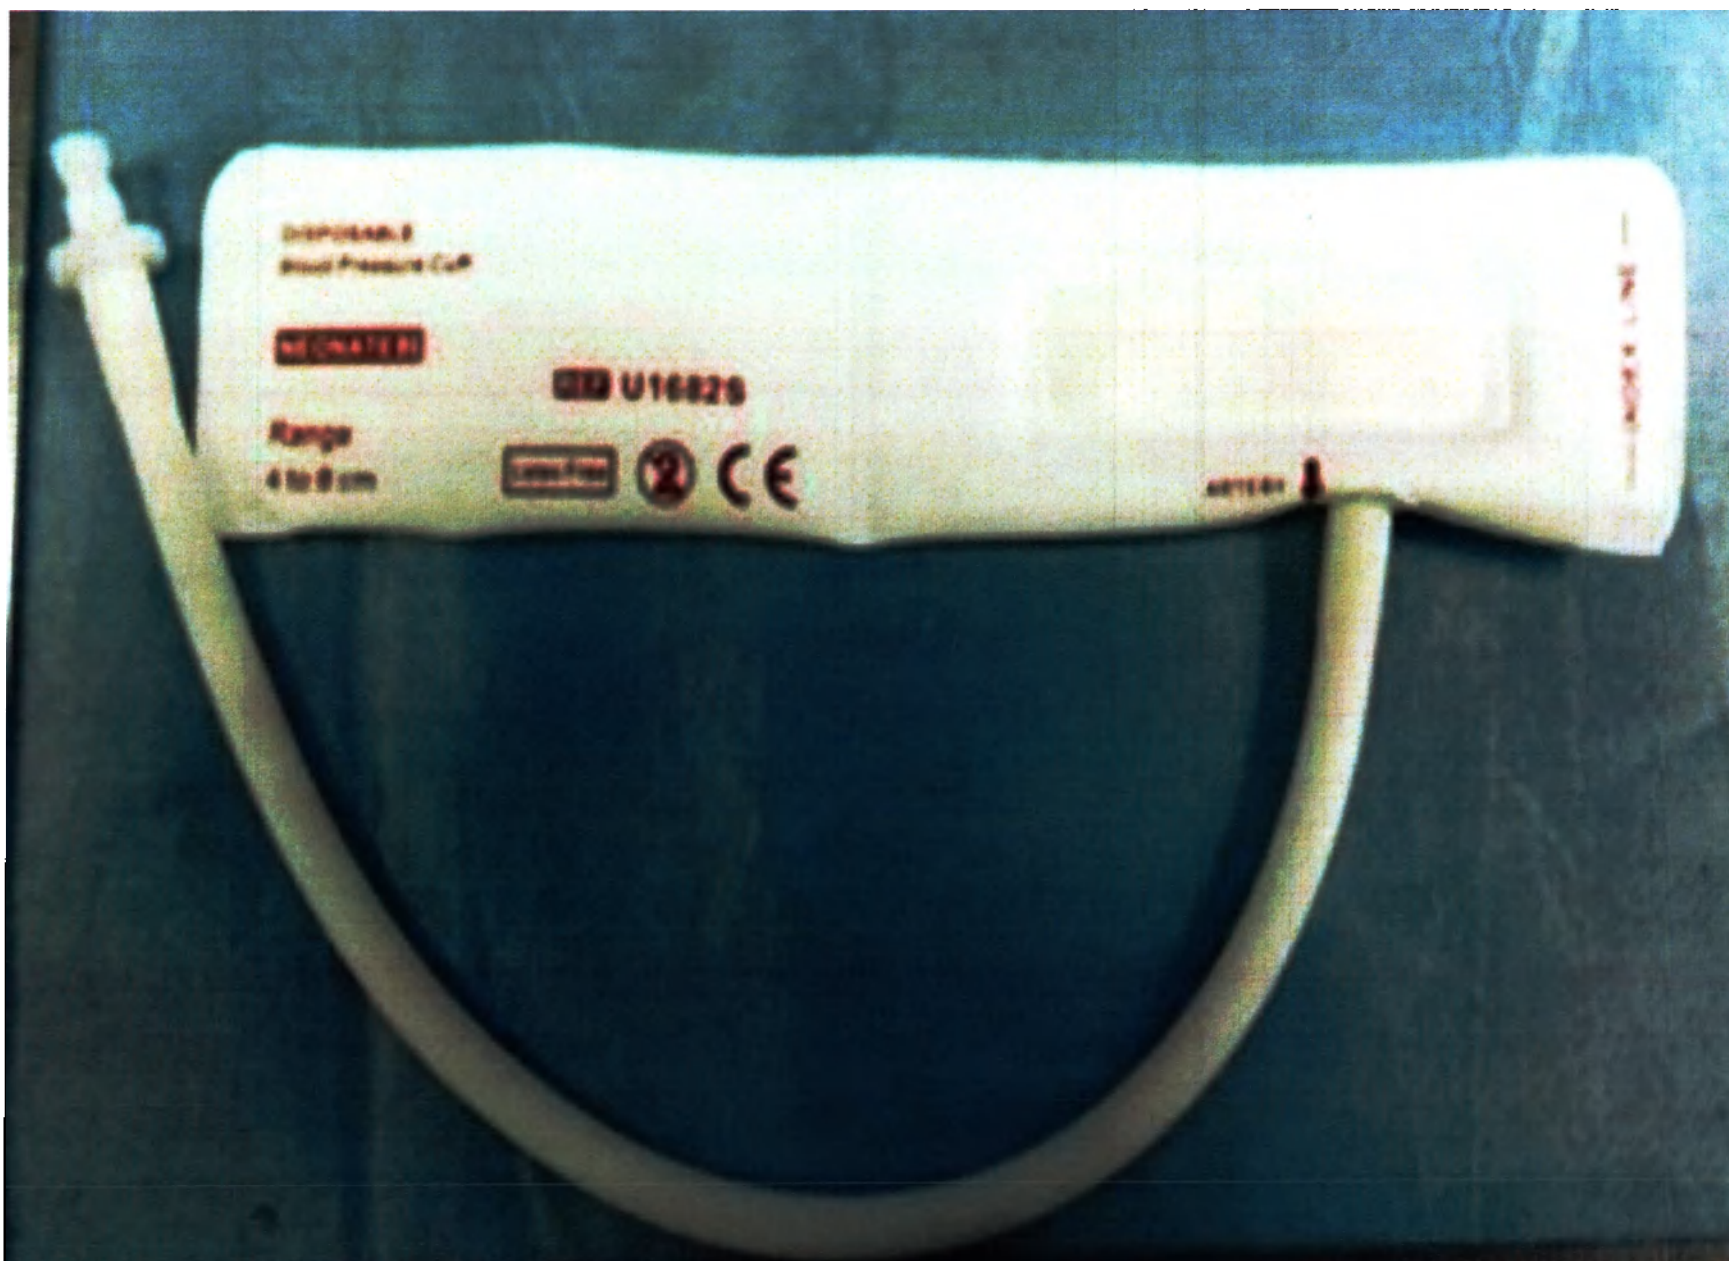


Манжета НИАД одноразовая / 6 - 11 см, модель U1683S



Манжета НИАД одноразовая / 7 - 13 см, модель U1684S



Датчик температуры для взрослых, кожный, модель TAS03-09

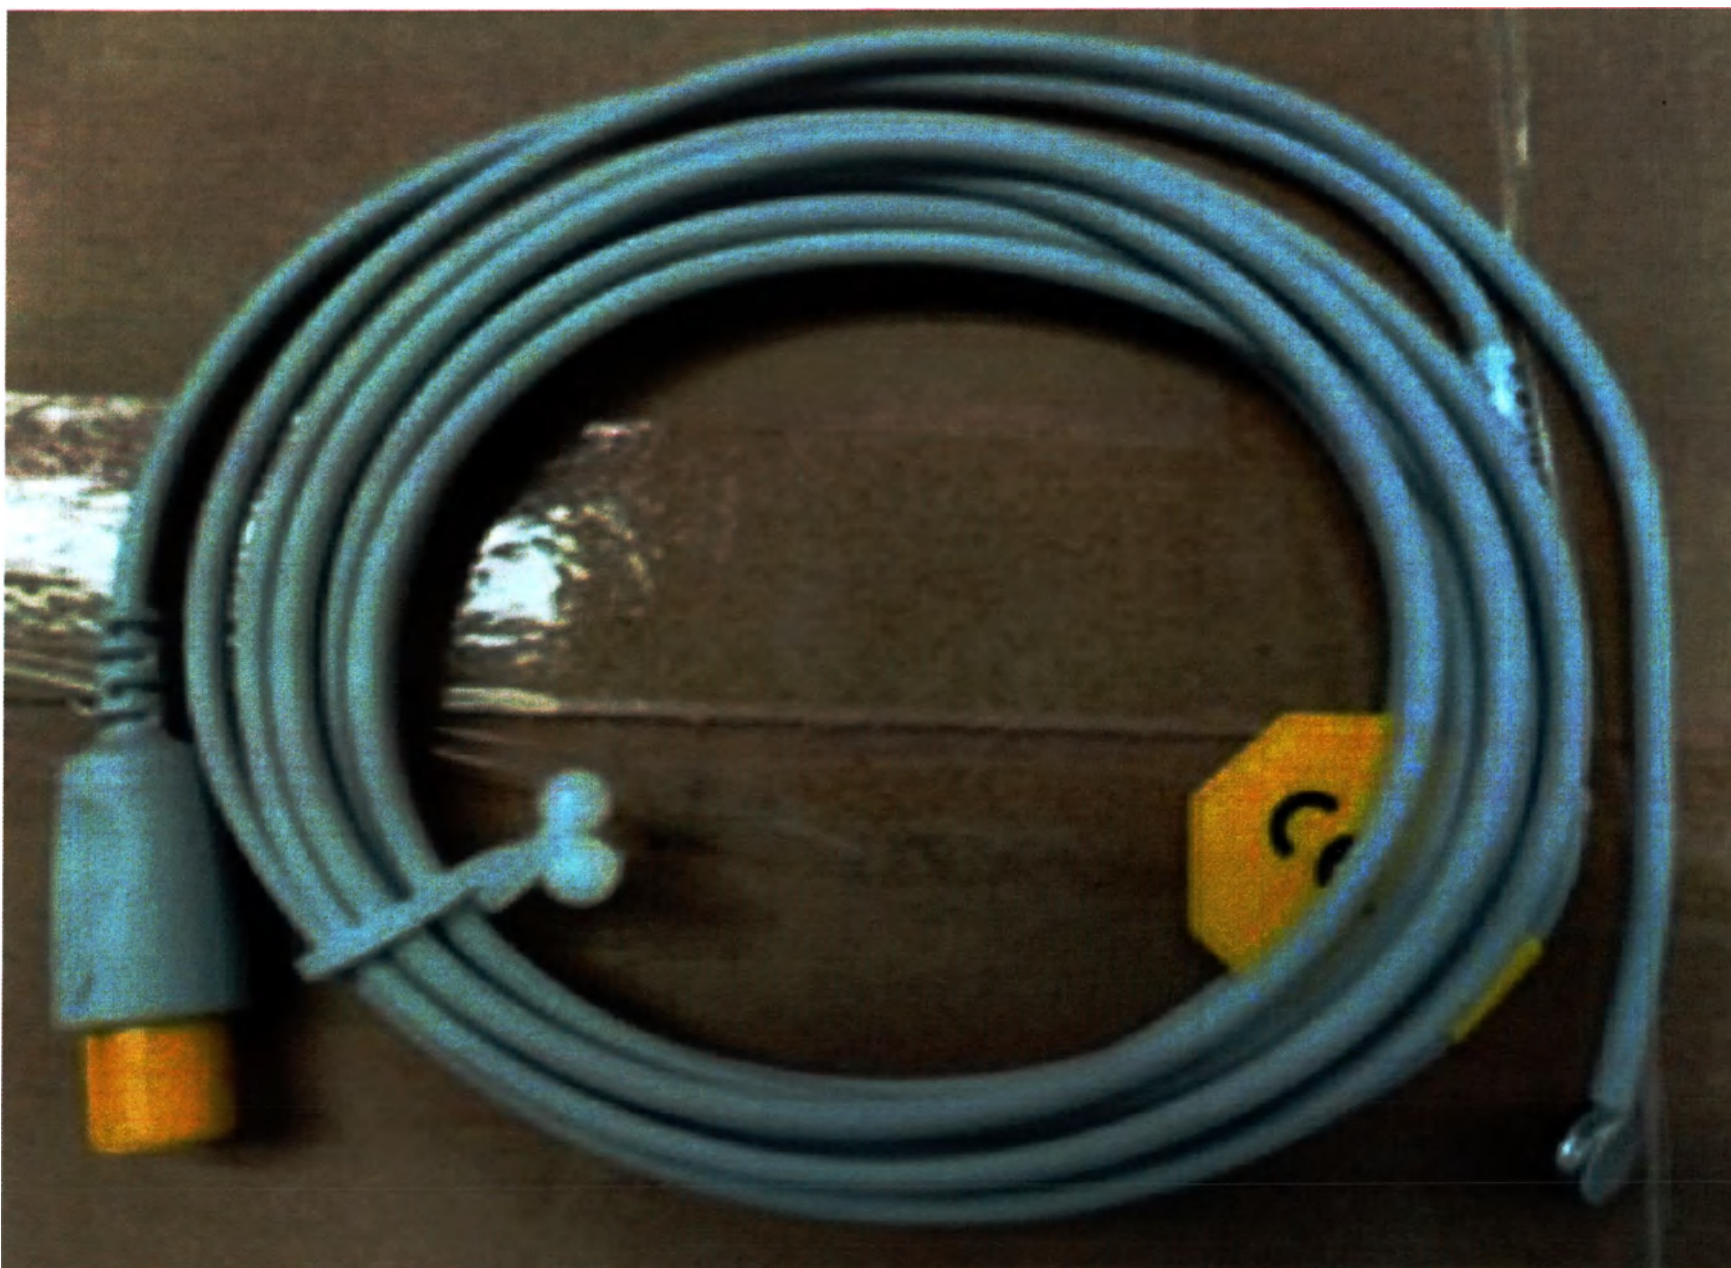

Датчик температуры для новорожденных, кожный, модель TPS03-01



Датчик температуры для взрослых/детей/новорожденных, ректальный, модель ТАЕ03-04



Датчик температуры для детей/новорожденных, ректальный, модель ТРЕ03-01




Кабель-удлинитель SpO2, «Неллкор», модель DOC-10




Многоразовый SpO2 датчик для взрослых, клипса «Неллкор», модель DS-100A



Многократный SpO₂ датчик для взрослых/детей/новорожденных, Y-образный «Неллкор», модель D-YS

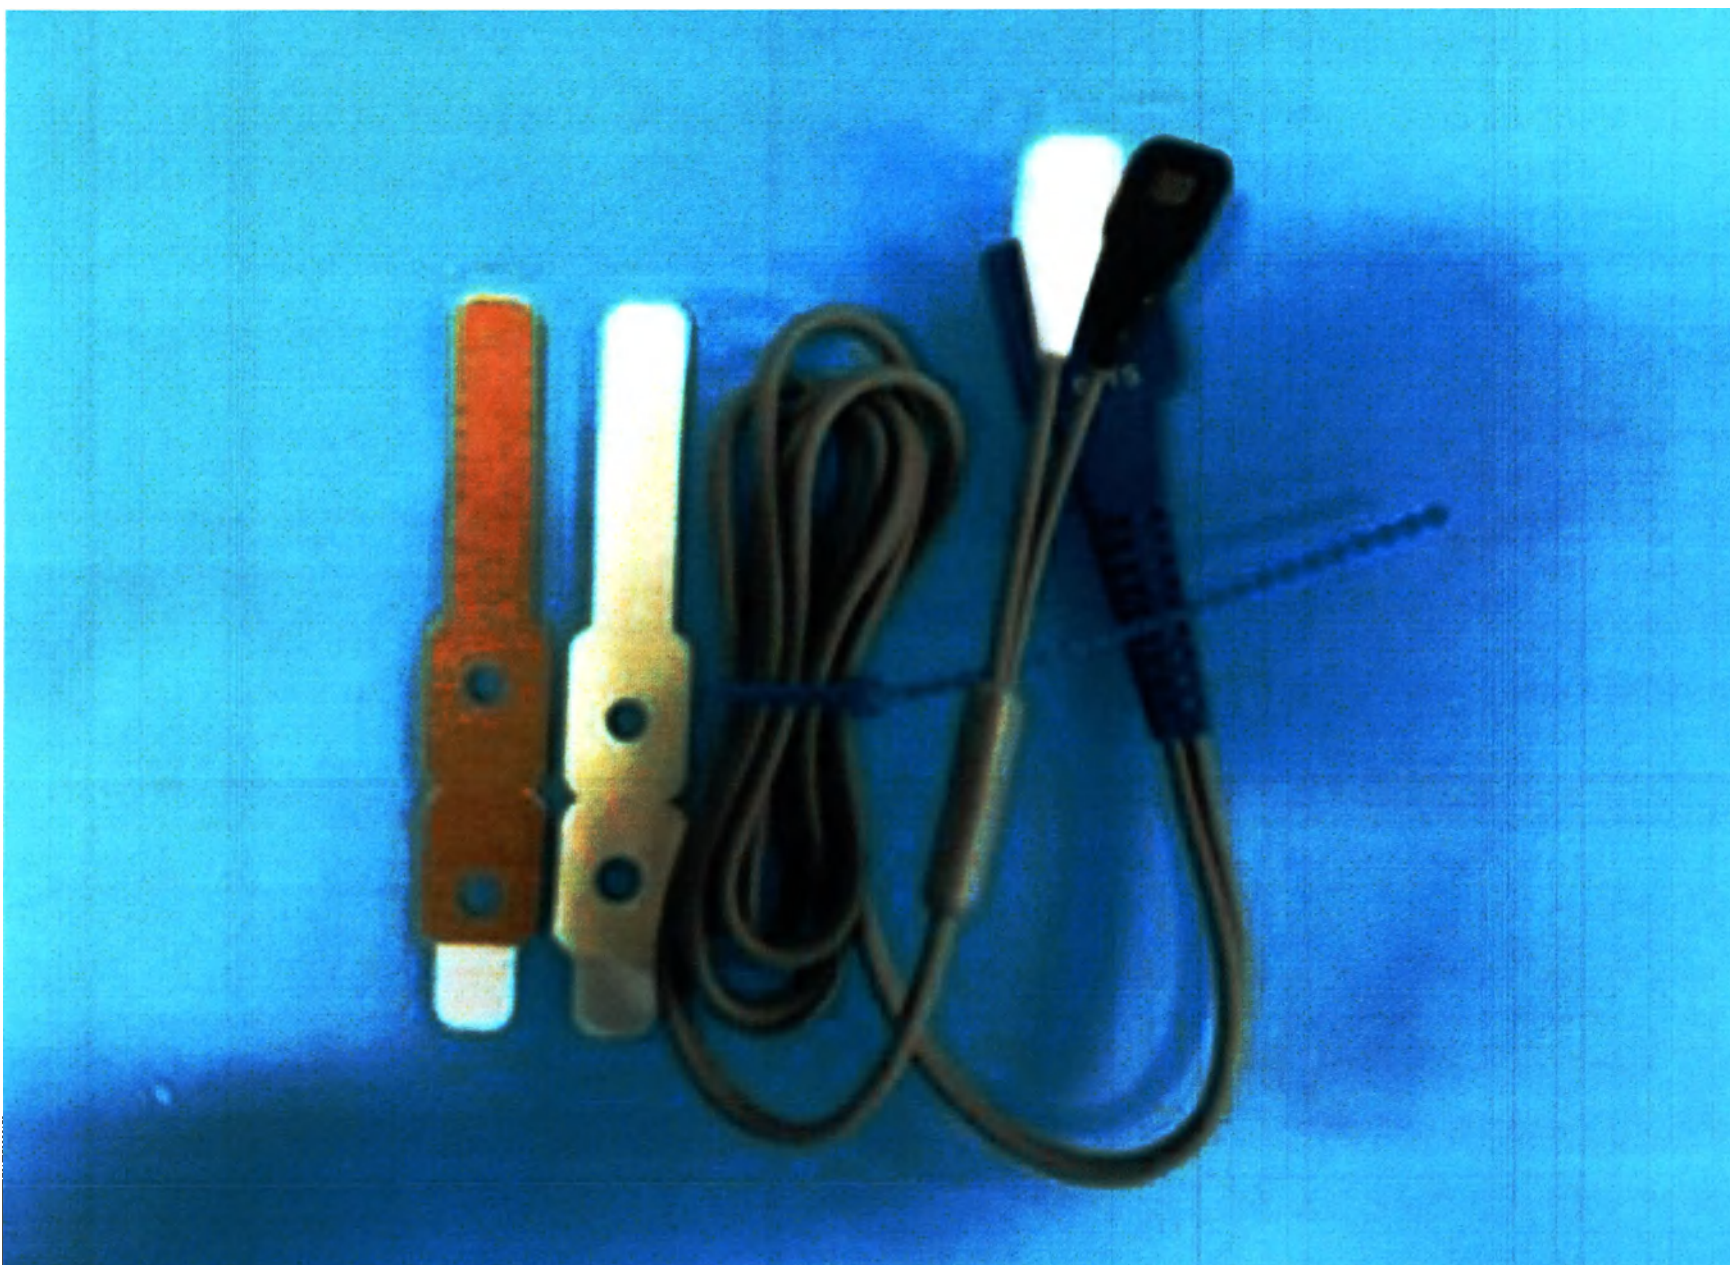


Ремешок-крепление датчика SpO2 Y-типа

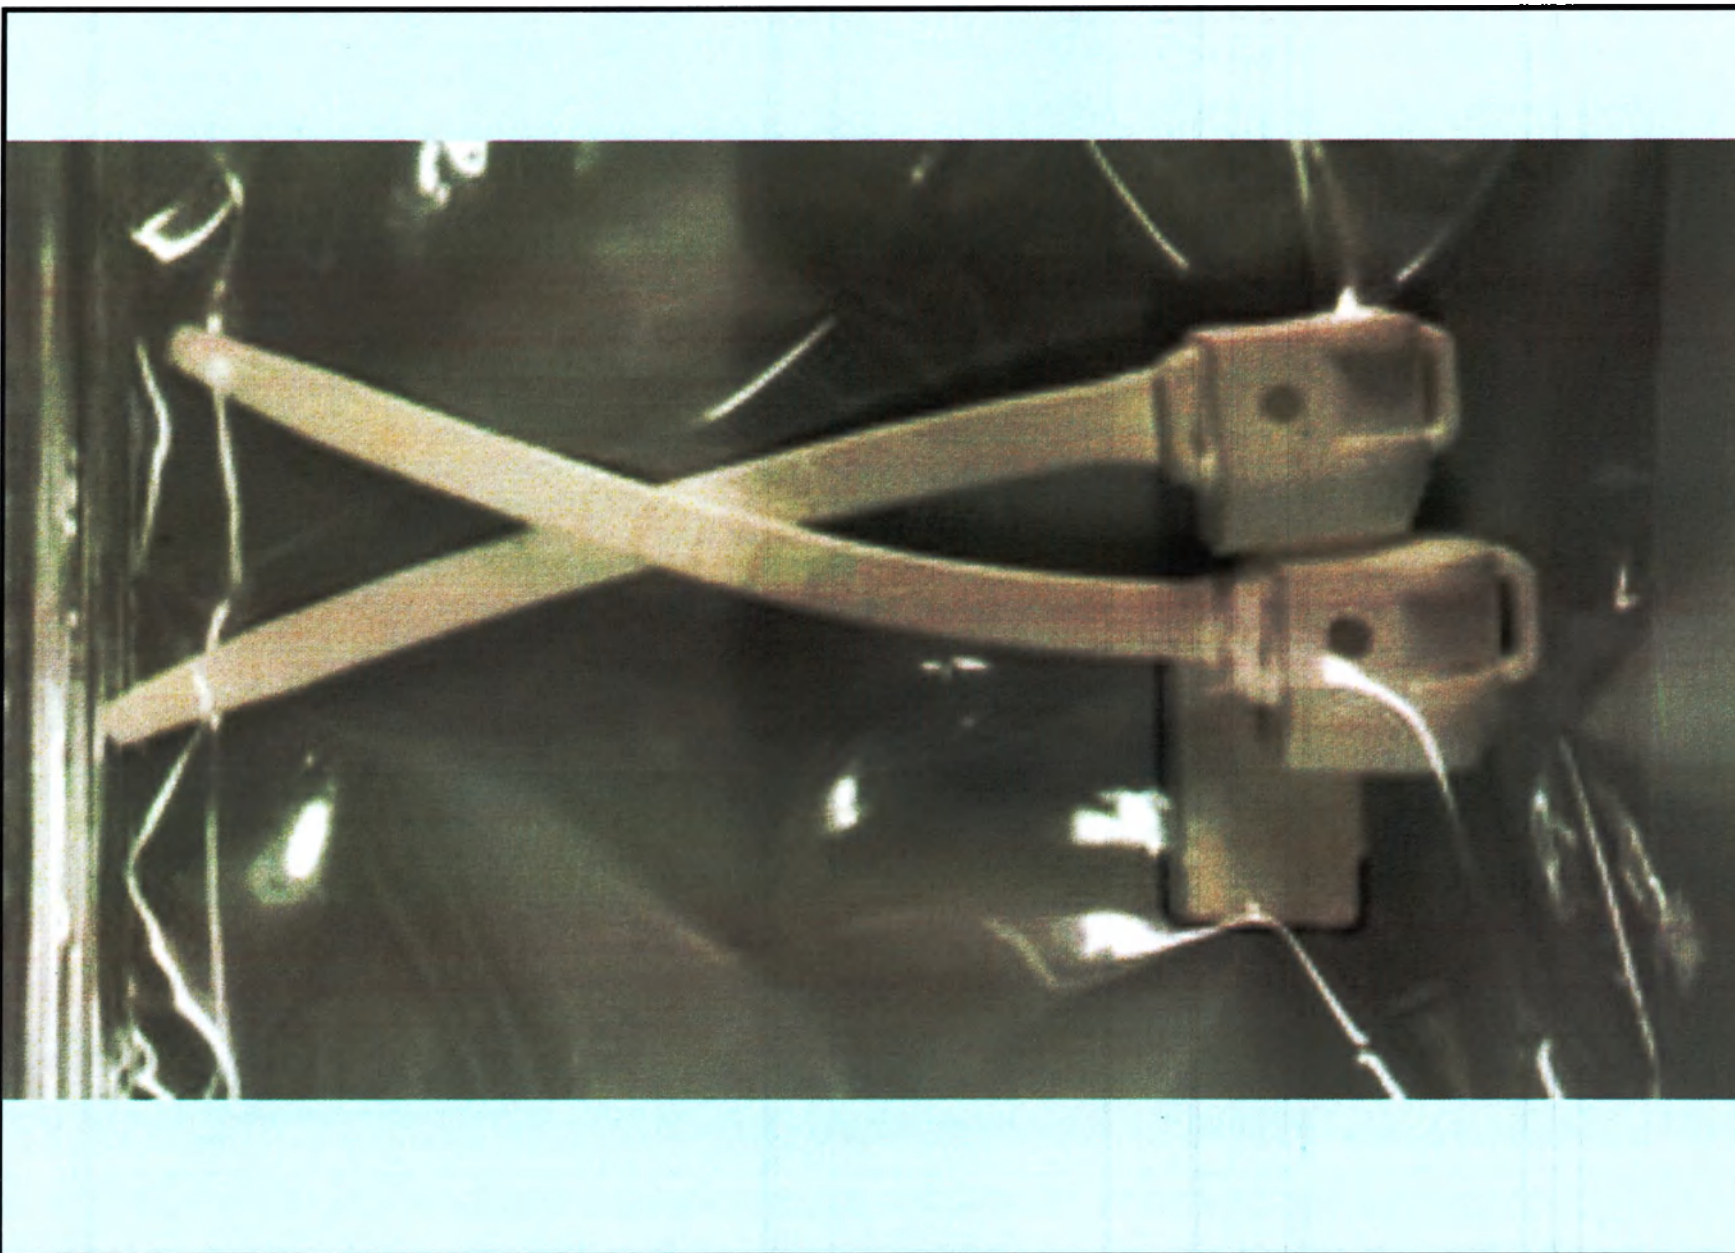


Кабель-удлиннитель SpO2, «Масимо», модель RD SET MD14-12



Многоразовый SpO2 датчик для взрослых, клипса "Масимо", модель RD SET DCI

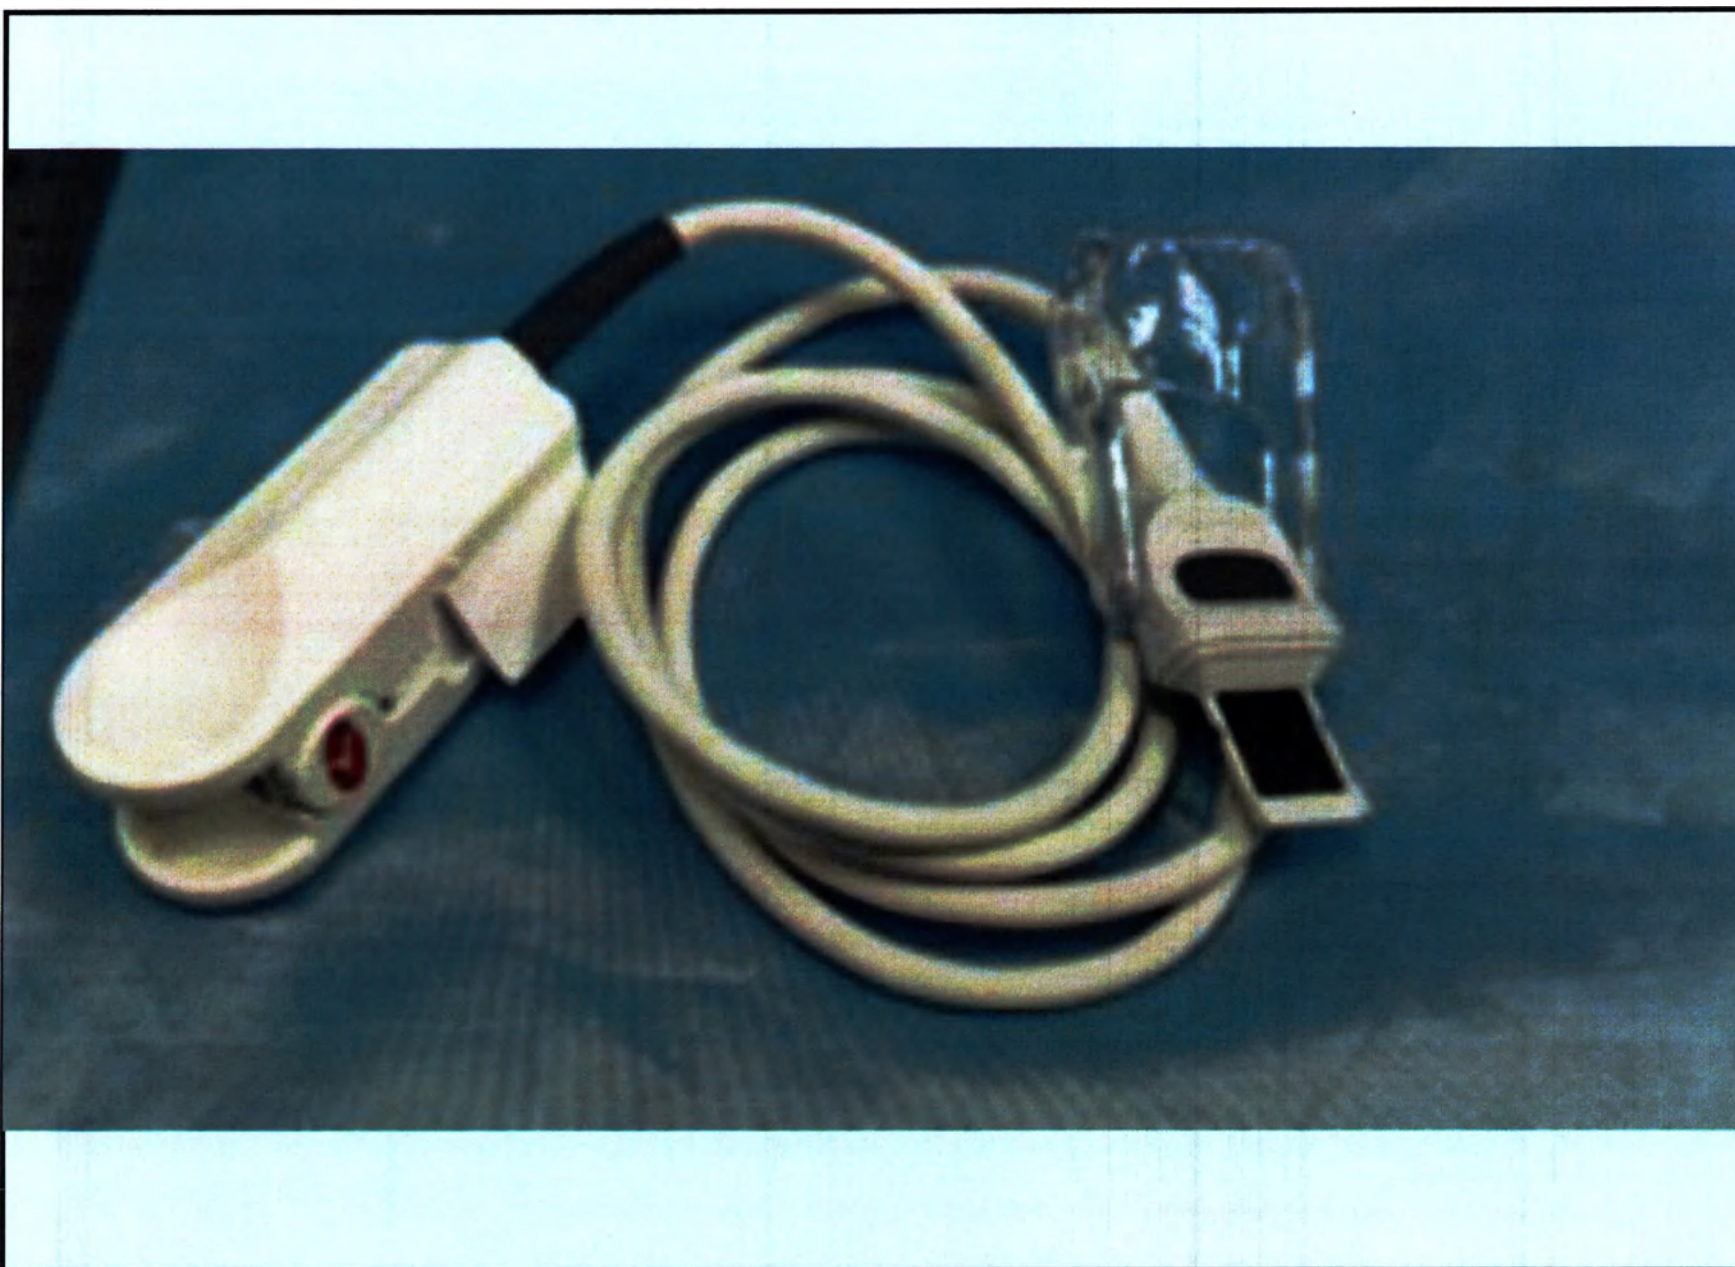

Многоразовый SpO₂ датчик для детей/ новорожденных, «Масимо», модель RD SET YI

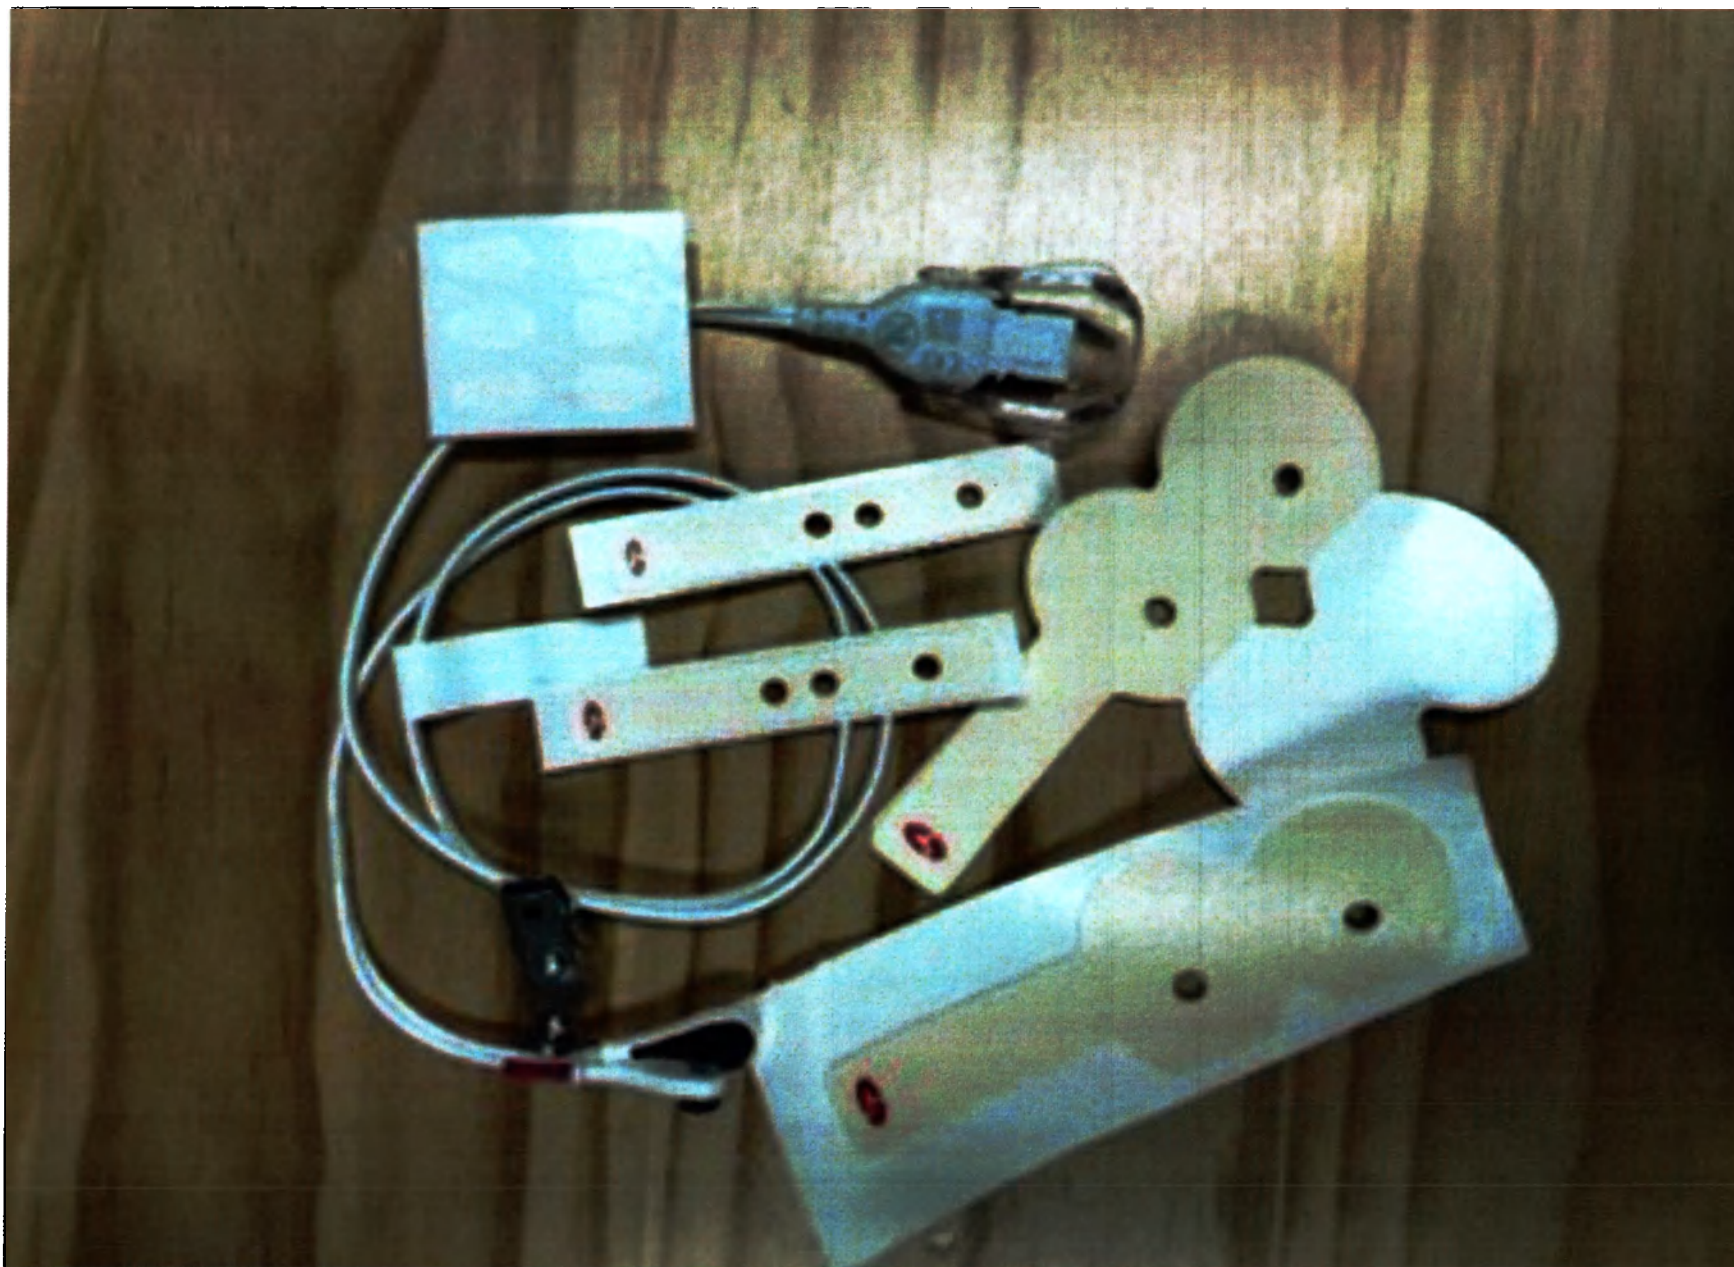


Кабель датчика ИАД, «Abbott», модель MC06-141110-01



Кабель датчика ИАД, «Braun», модель MC06-141115-01



Кабель датчика ИАД, «ВД», модель MC06-141113-01

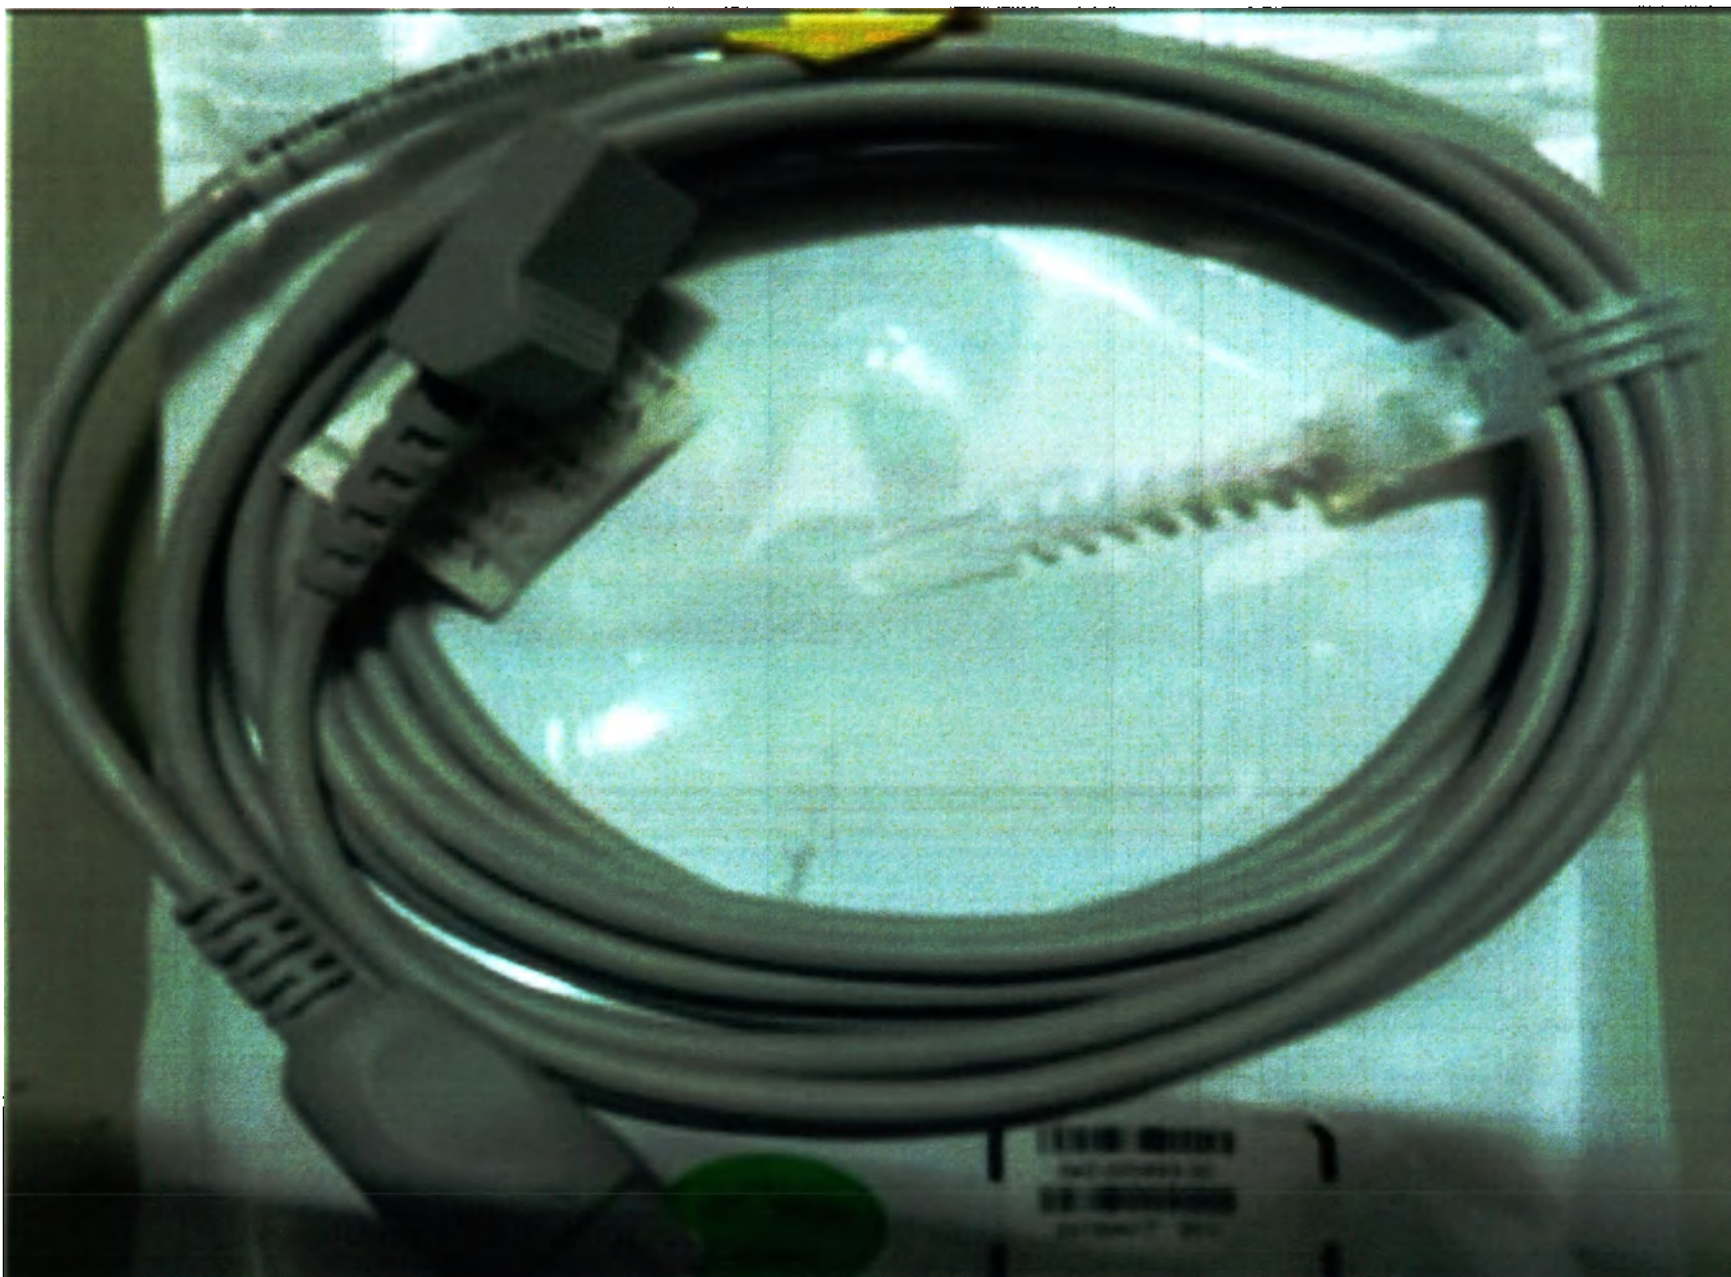


Кабель датчика ИАД, «Edward», модель MC06-141112-01



Датчик ИАД «Abbott», стерильный, модель РТ-1 1500




Датчик ИАД «BD», стерильный, модель РТ-1 1300

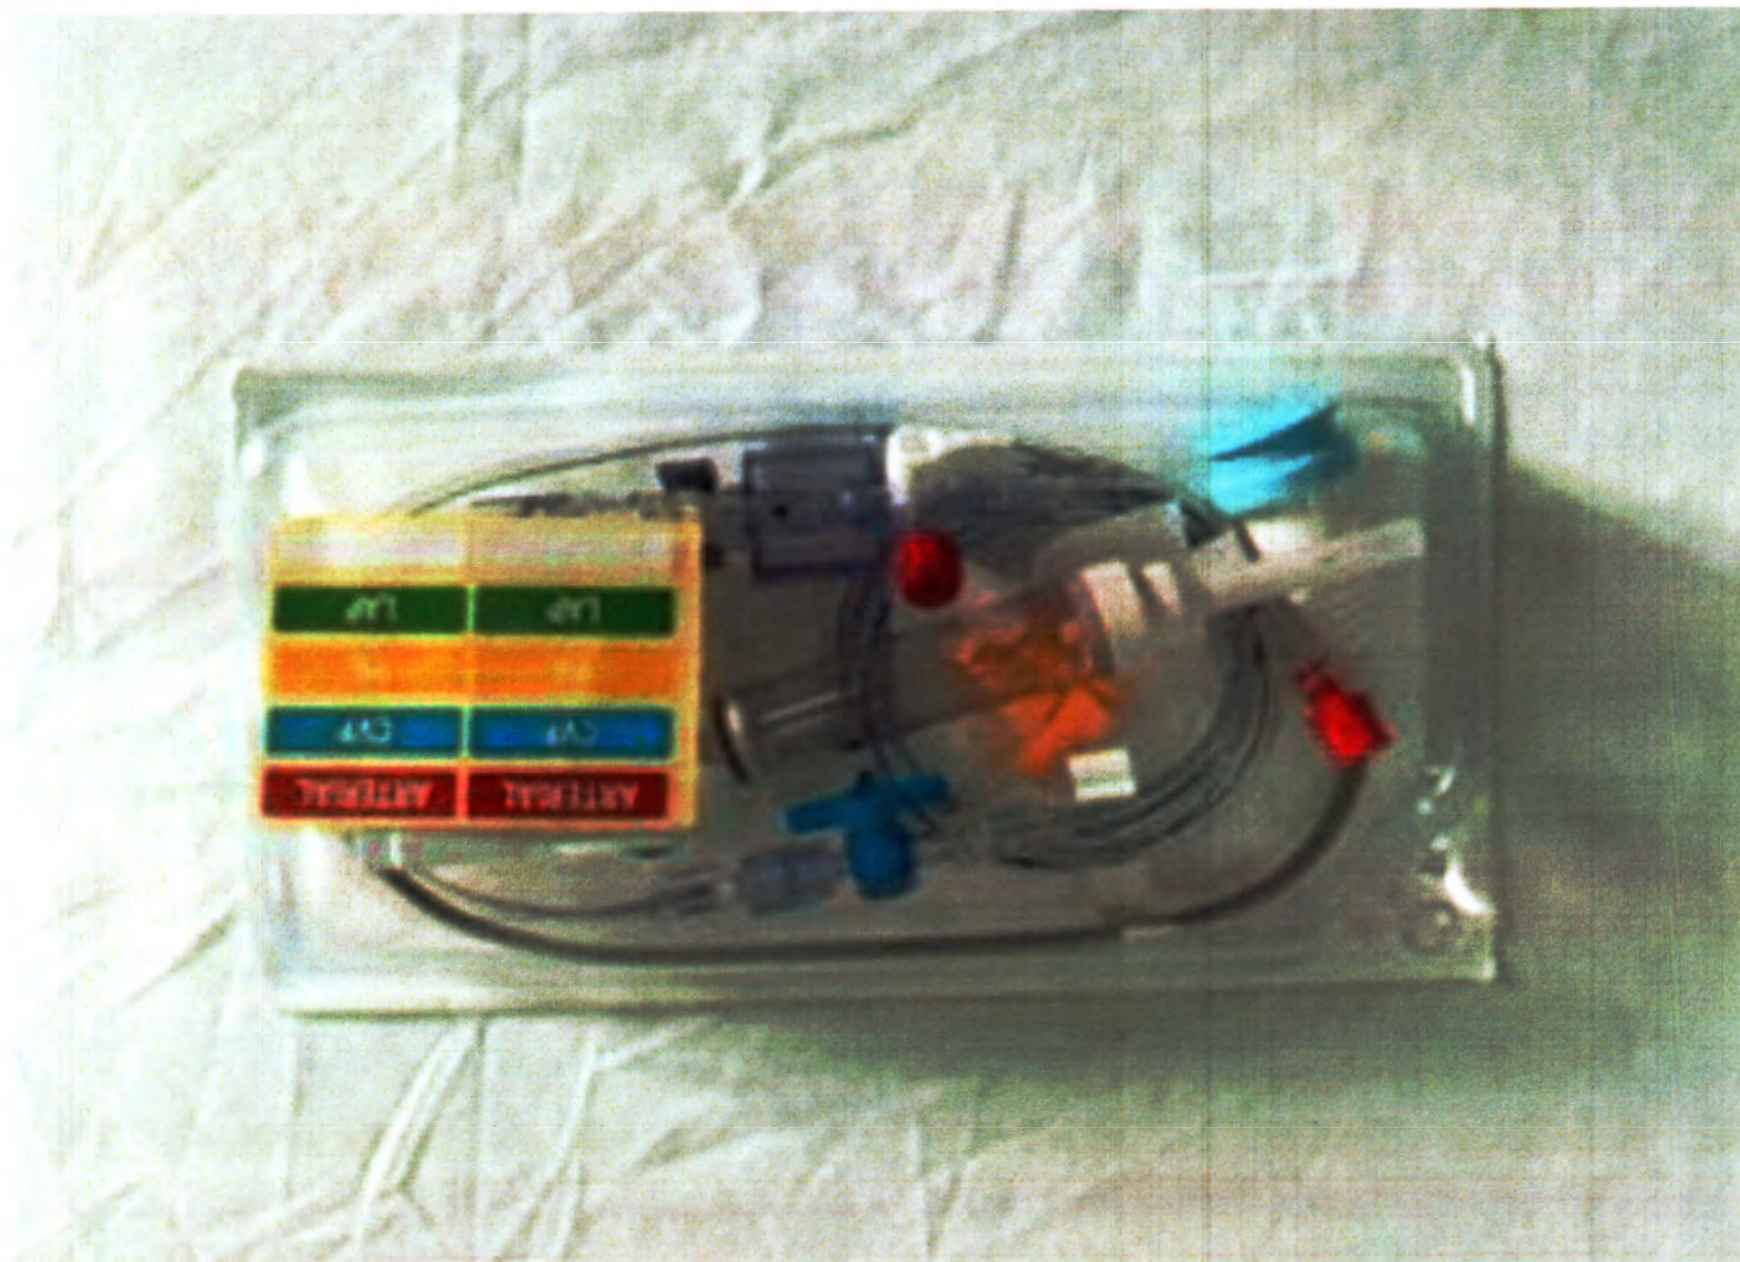


Датчик ИАД «Braun», стерильный, модель РТ-1 1200



Датчик ИАД «Edward», стерильный, модель PT-1 1400

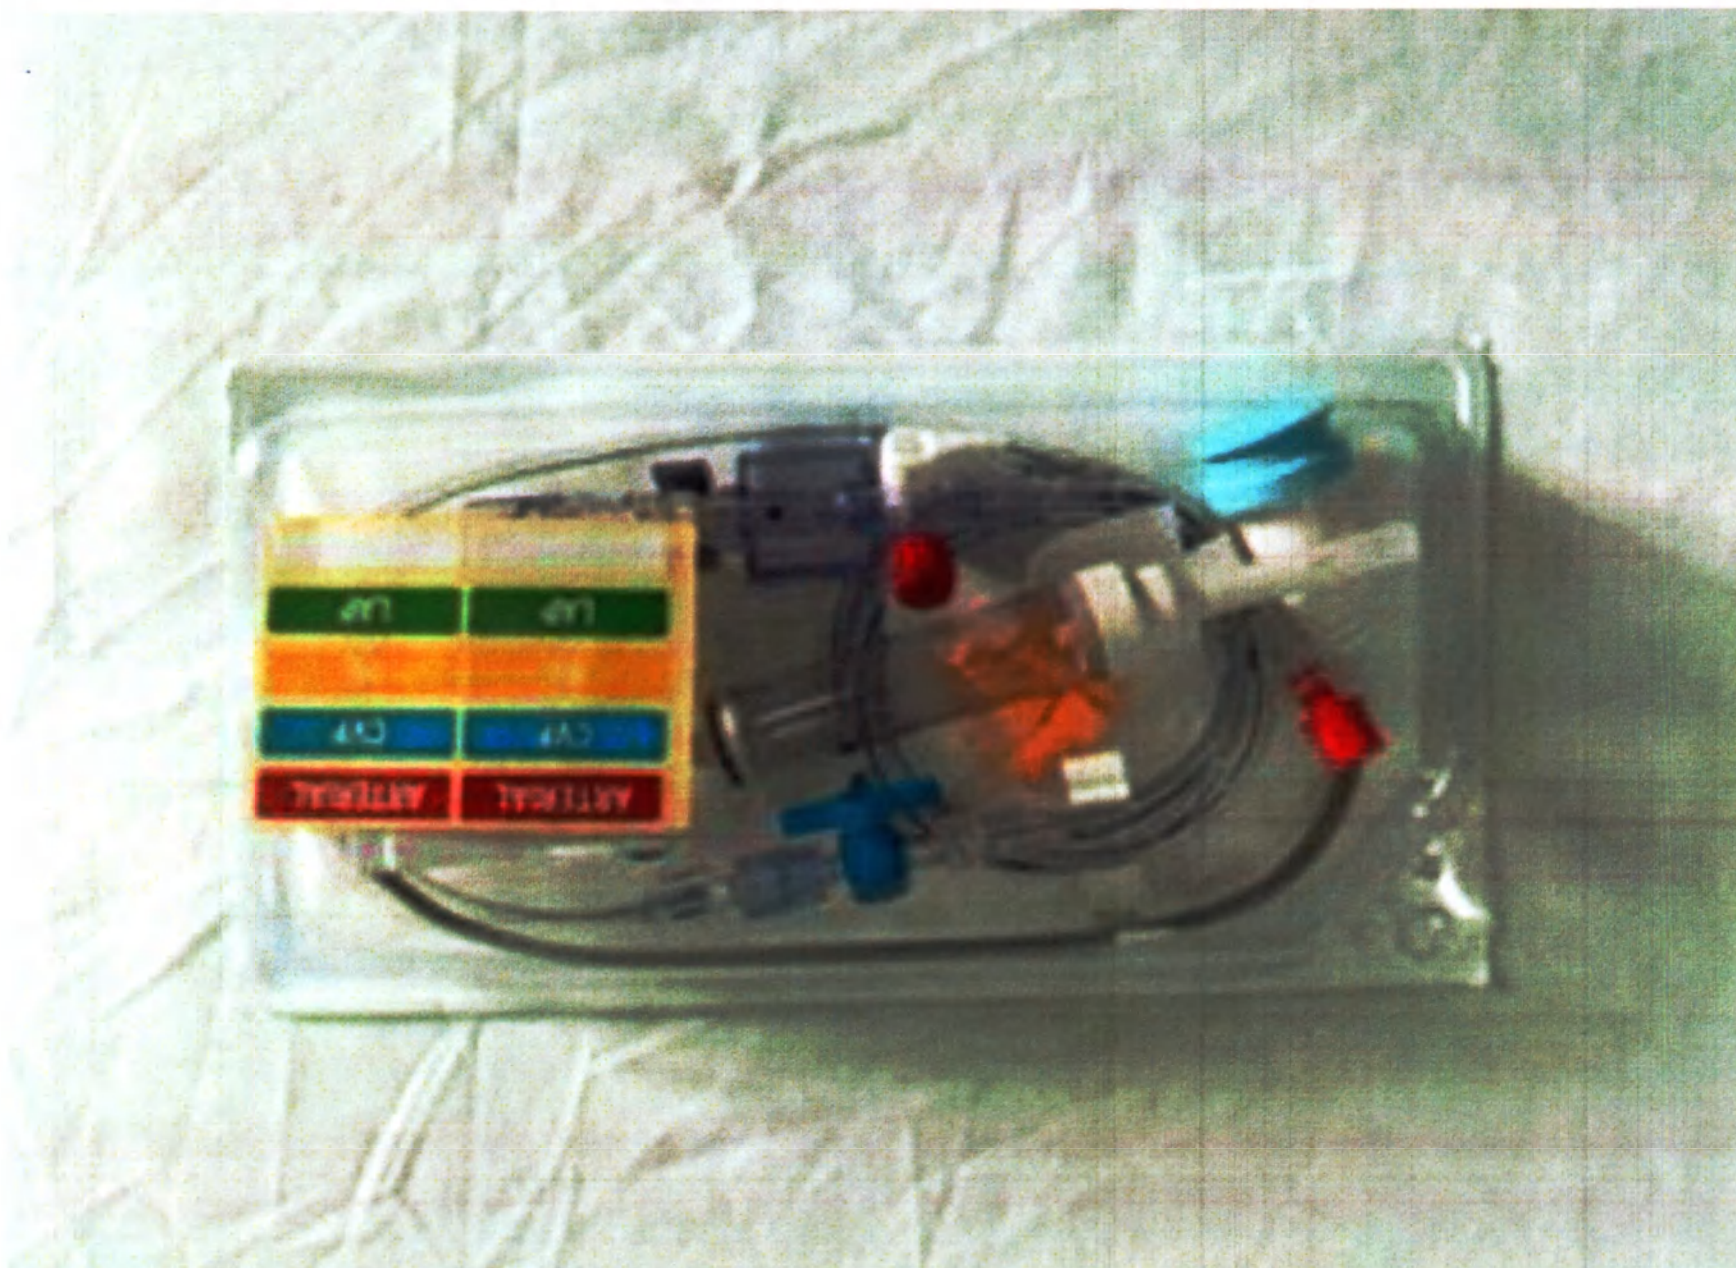

Кабель ИАД

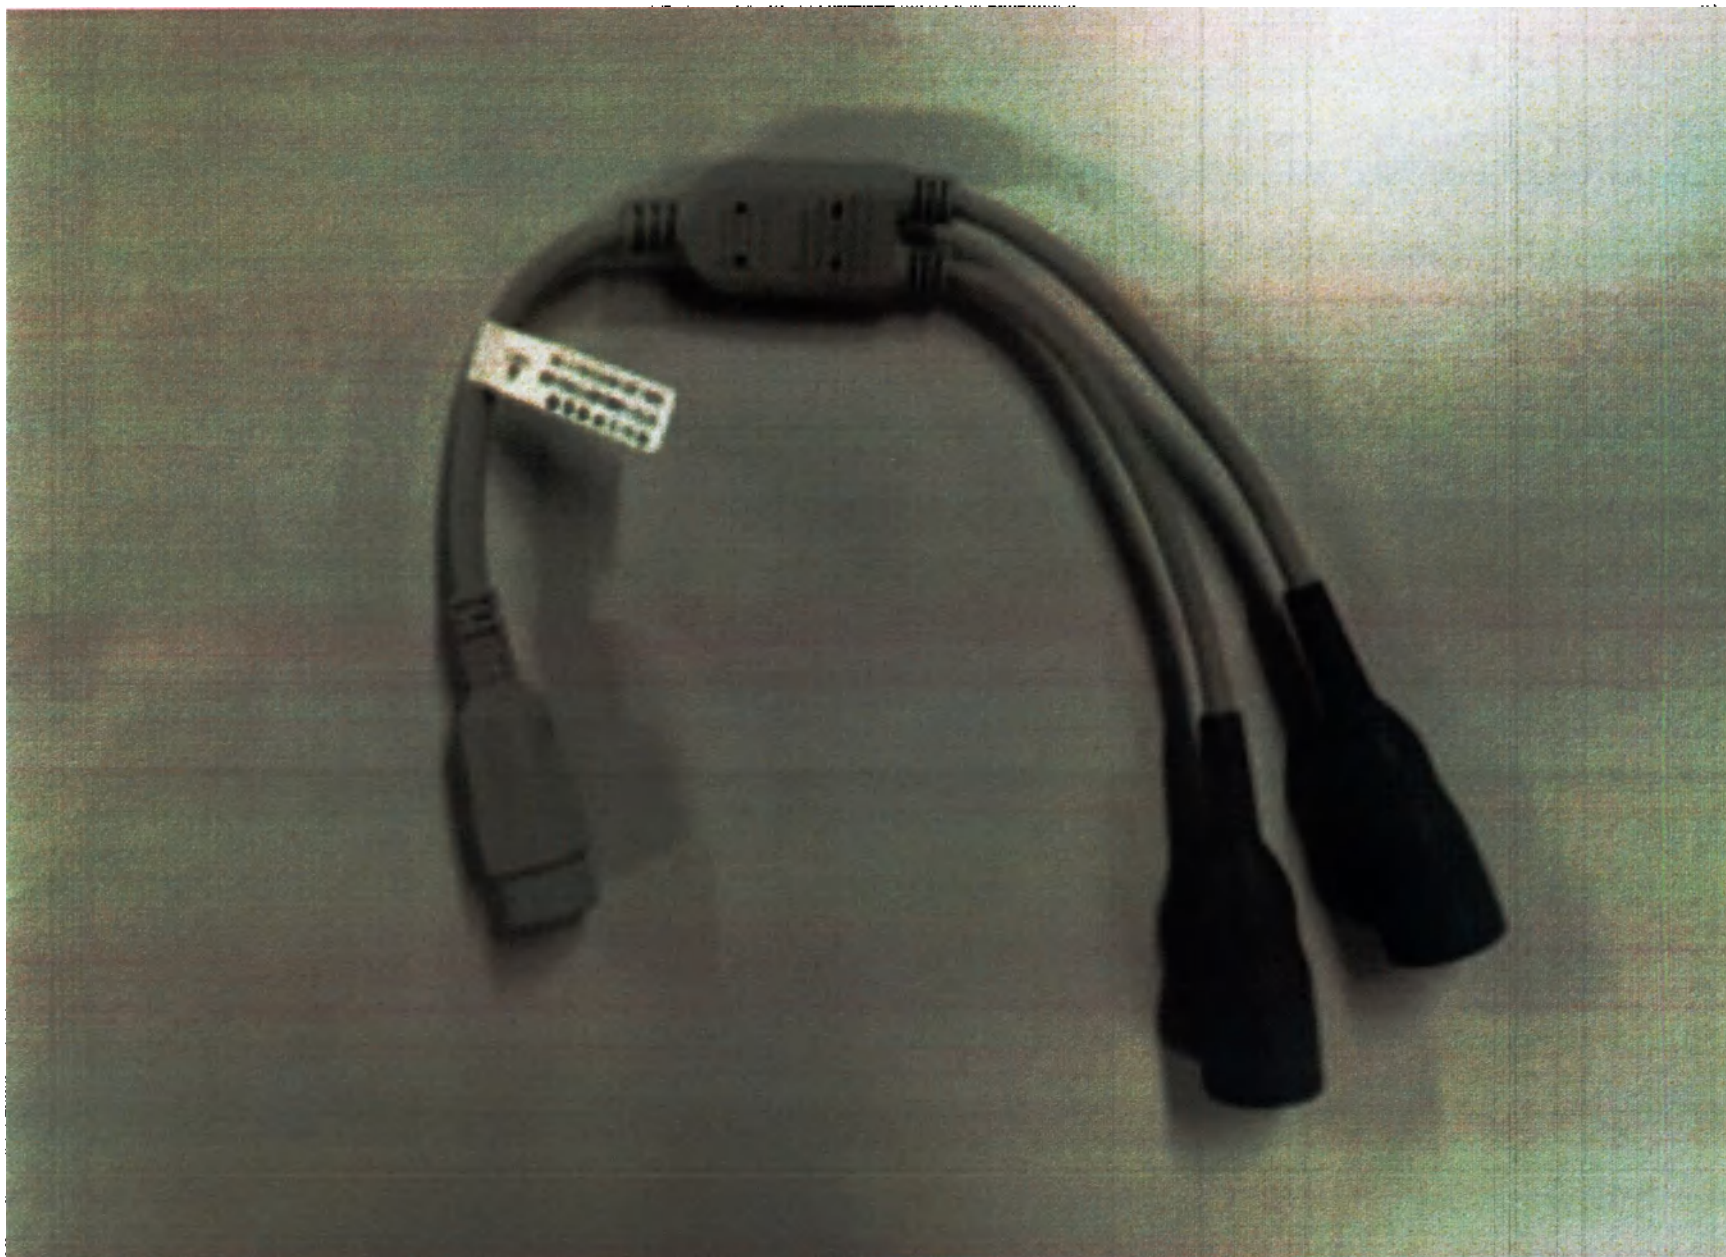

Кабель-адаптер со смещением сердечника




Модуль CO₂ основного потока, «Масимо»



Воздушный адаптер модуля CO2 «Масимо» для взрослых/детей, модель CAT.NO.106220




Воздушный адаптер модуля CO2 «Масимо» для новорождённых/младенцев, модель CAT.NO.106260

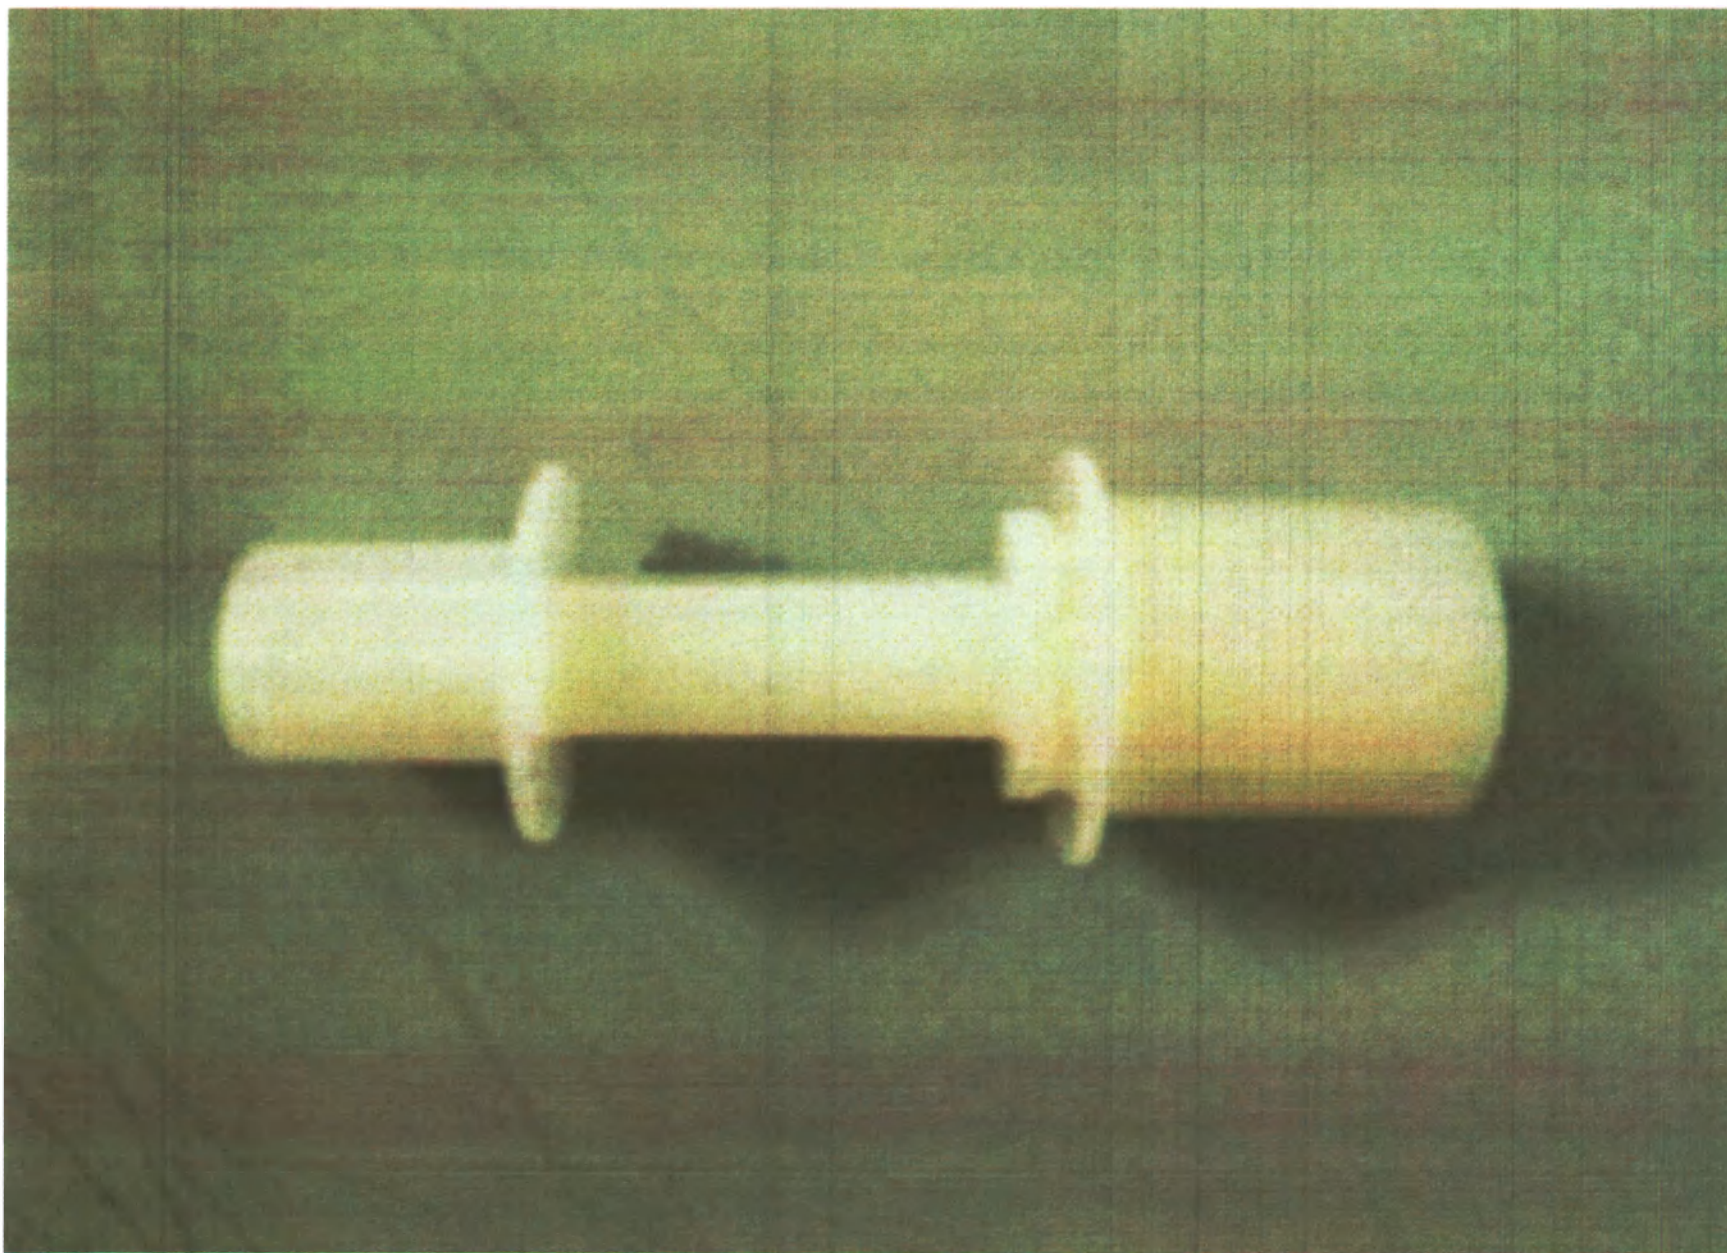

Интерфейсный кабель модуля CO2 DB9/7, модель 98ME07GC968




Модуль CO₂ бокового потока «Масимо»

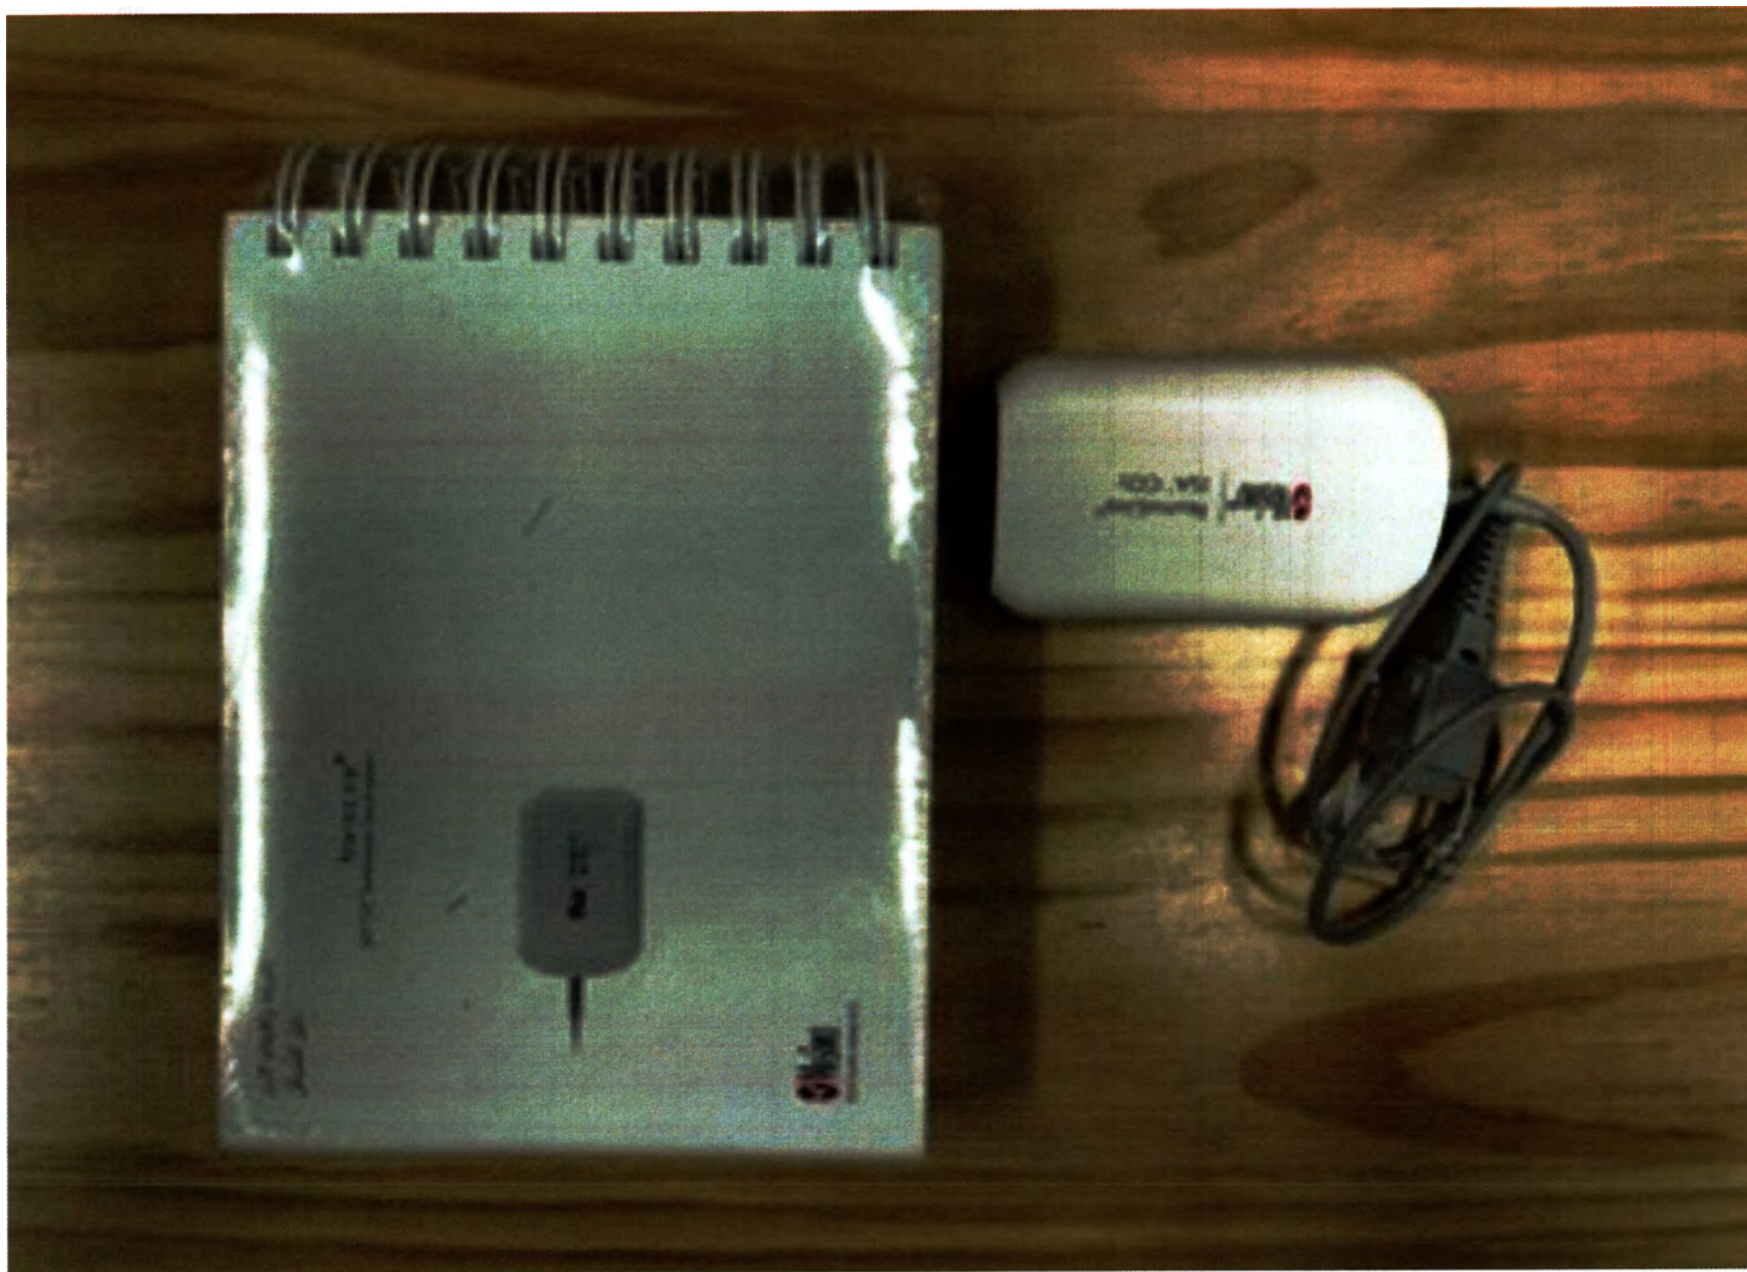

Назальная канюля для взятия пробы CO₂ для новорожденных, коннектор "Номолайн", 3м, модель 3832




Назальная канюля для взятия пробы CO₂ для детей, коннектор "Номолайн", 3м, модель 3834

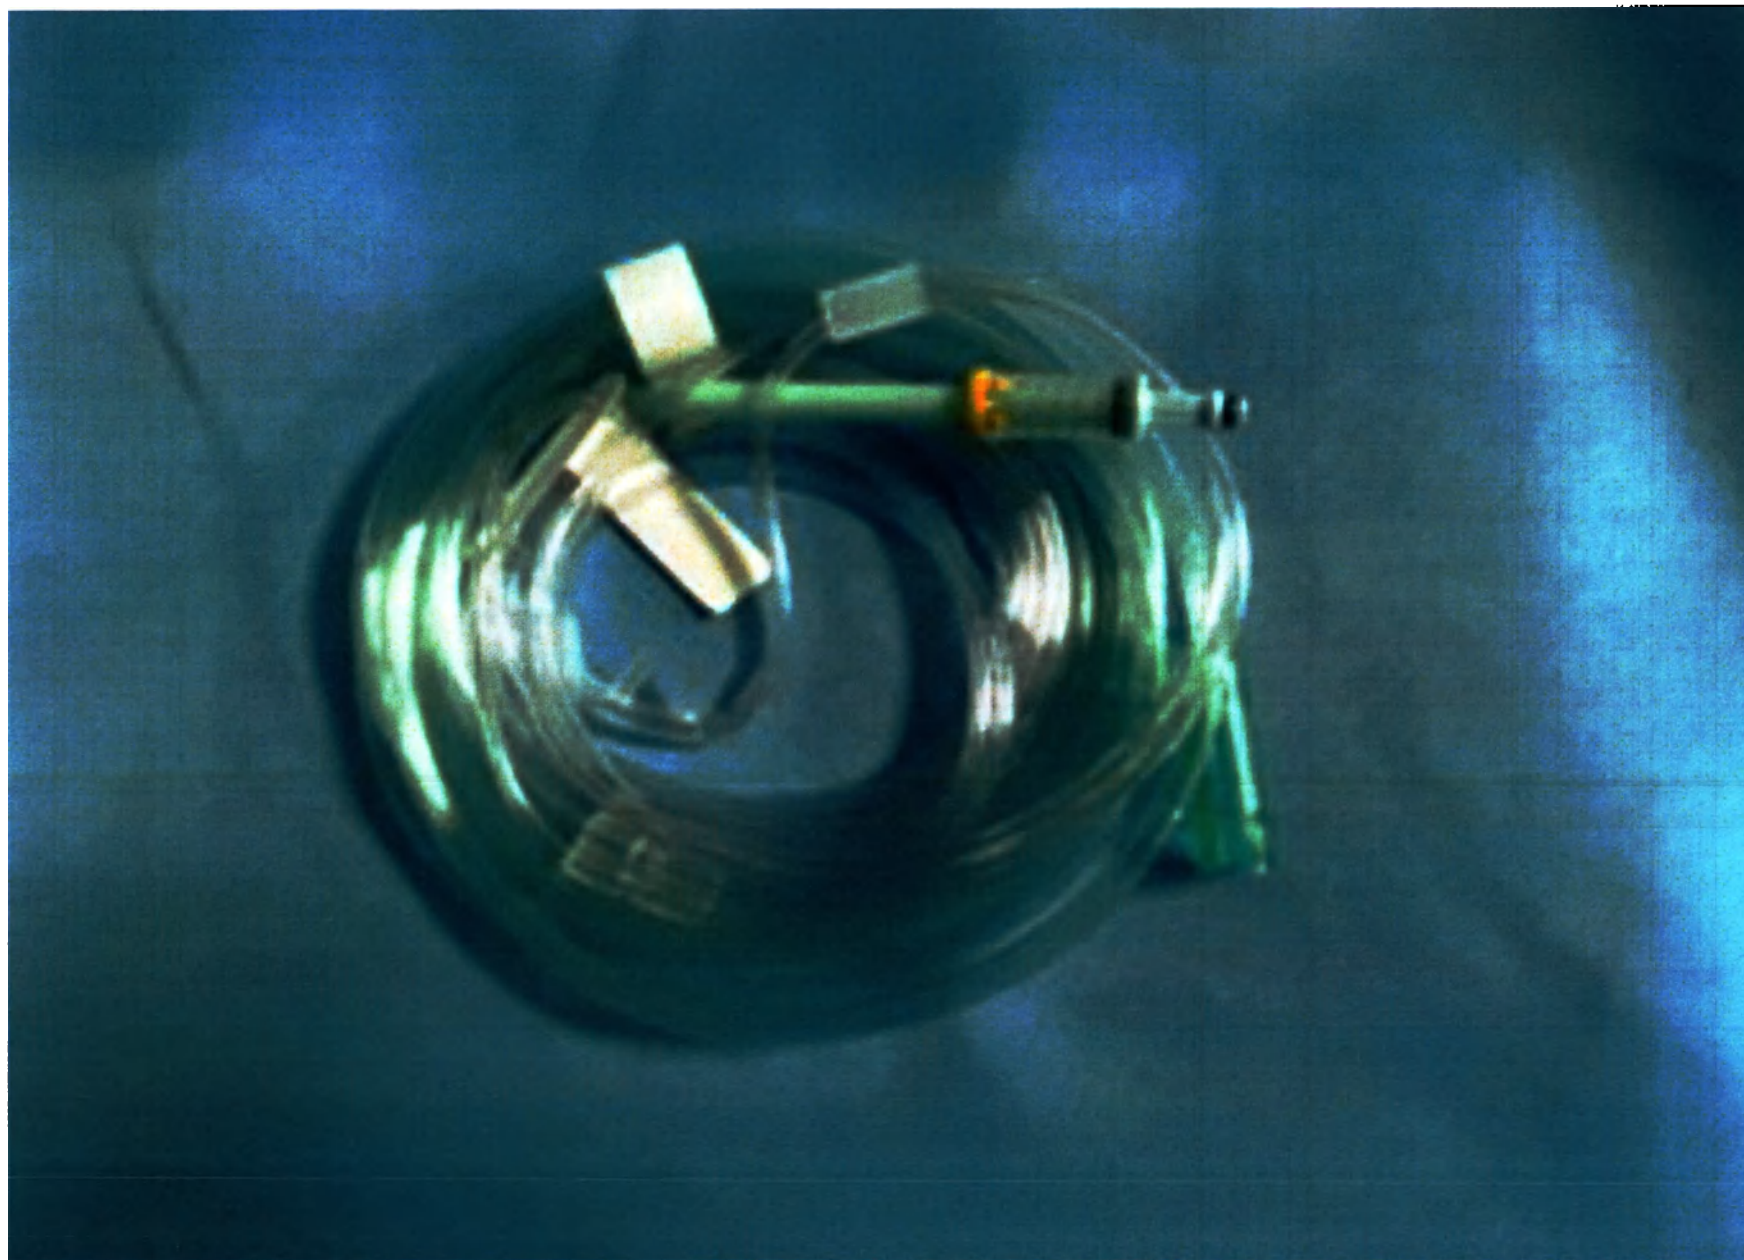

Назальная канюля для взятия пробы CO₂ для взрослых, коннектор "Номолайн", 3м, модель 3830




Линия отбора проб газа для взрослых/детей, коннектор "Номолайн", 3м, модель 3828

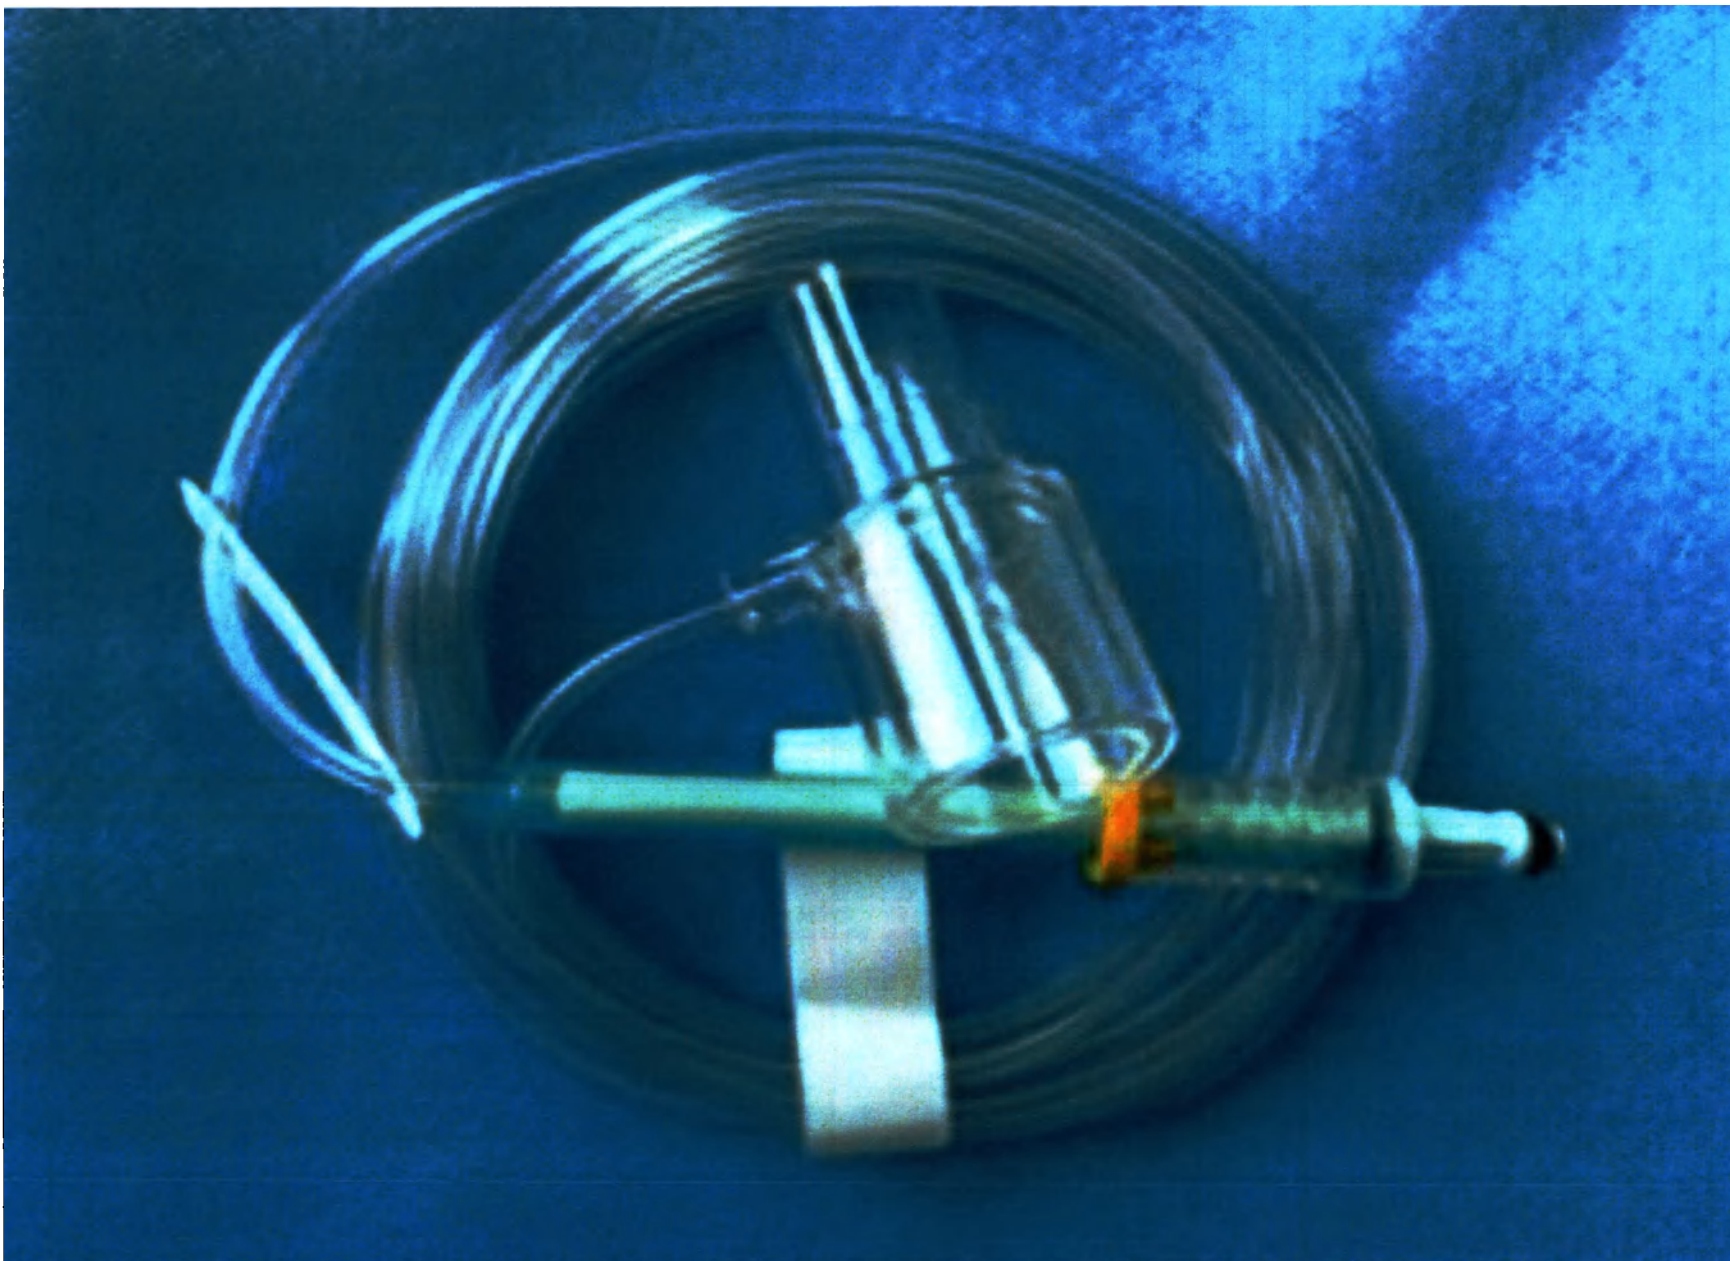

Линия отбора проб газа для новорожденных коннектор "Номолайн", 2м, модель 3829



Линия отбора проб газа с назальной/ротовой канюлей для детей, модель 3838

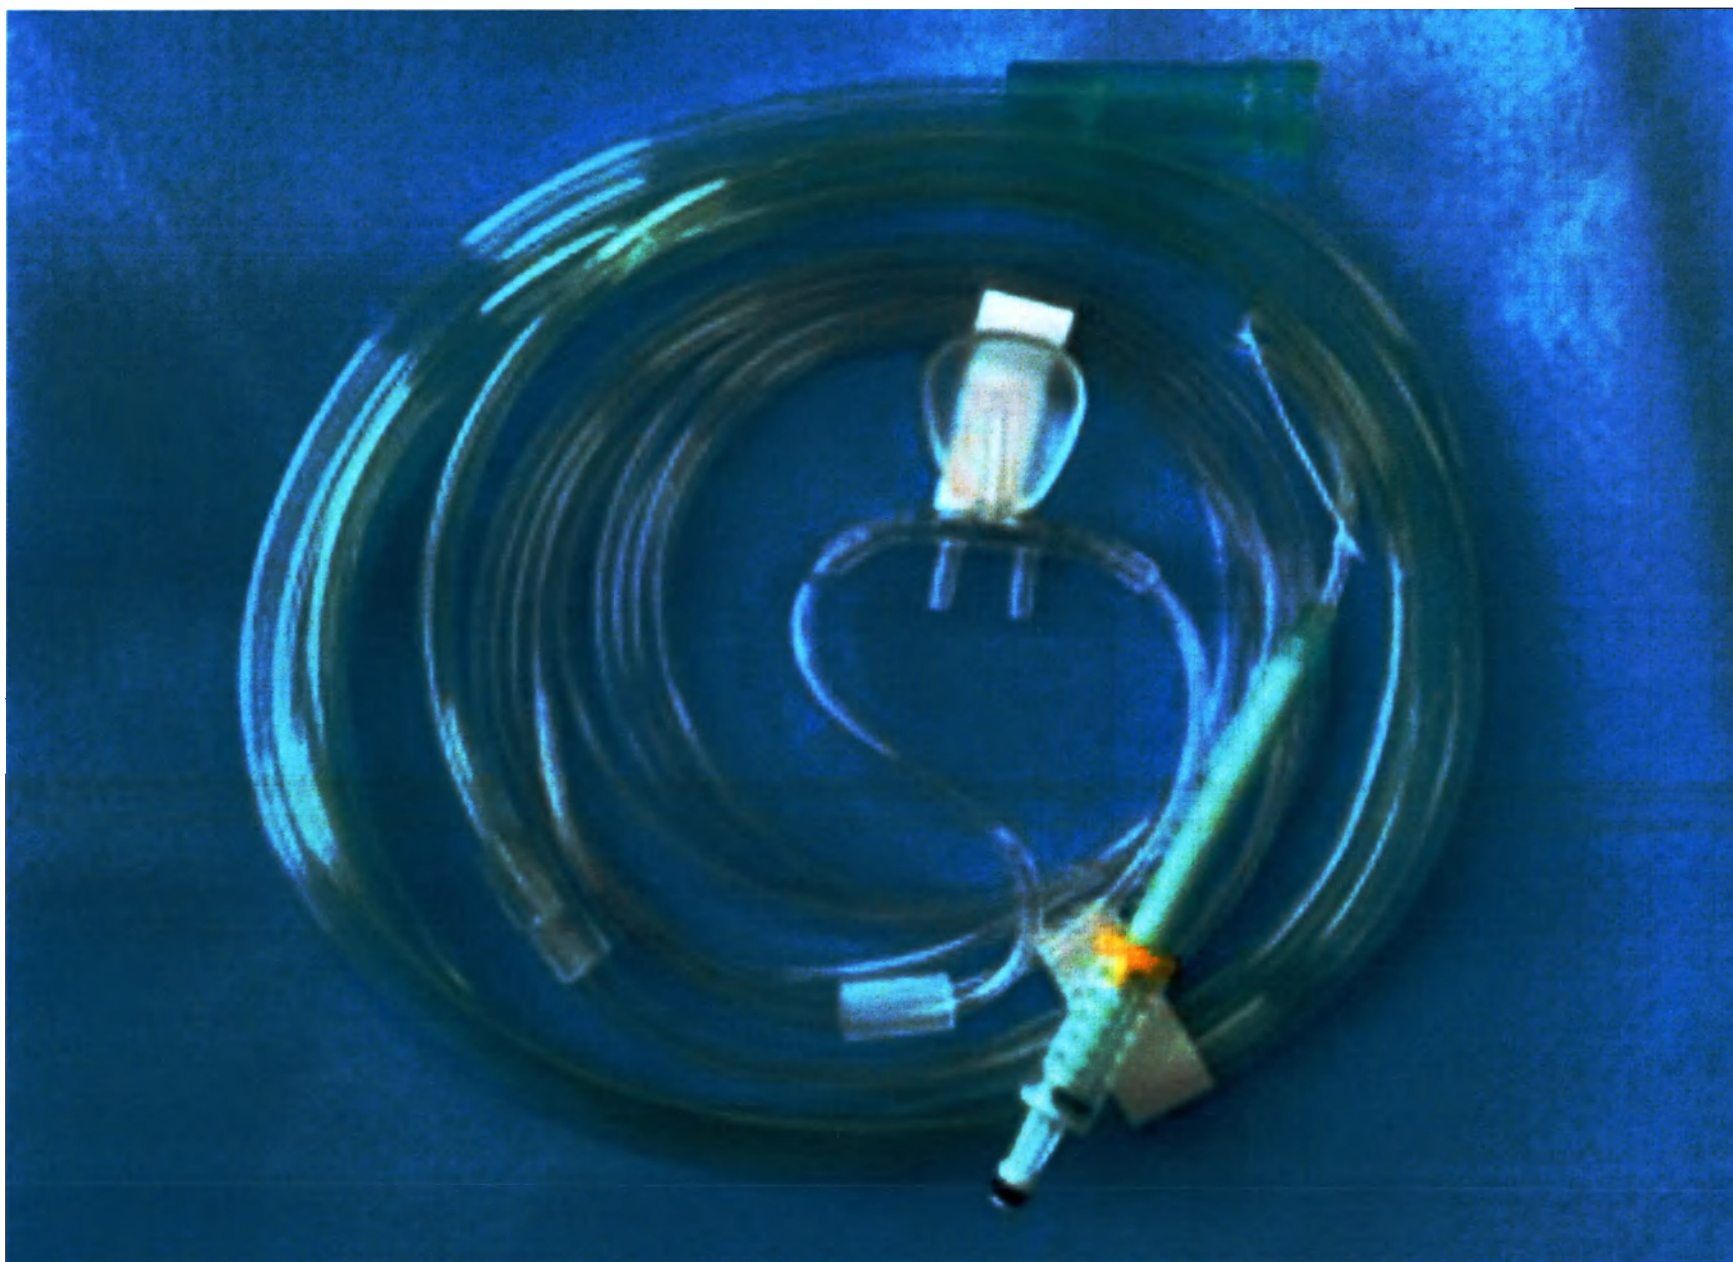


Линия отбора проб газа с назальной/ротовой канюлей для взрослых, модель 3837




Влагосборник «Комен»




Трубка для газоанализа, «Комен»

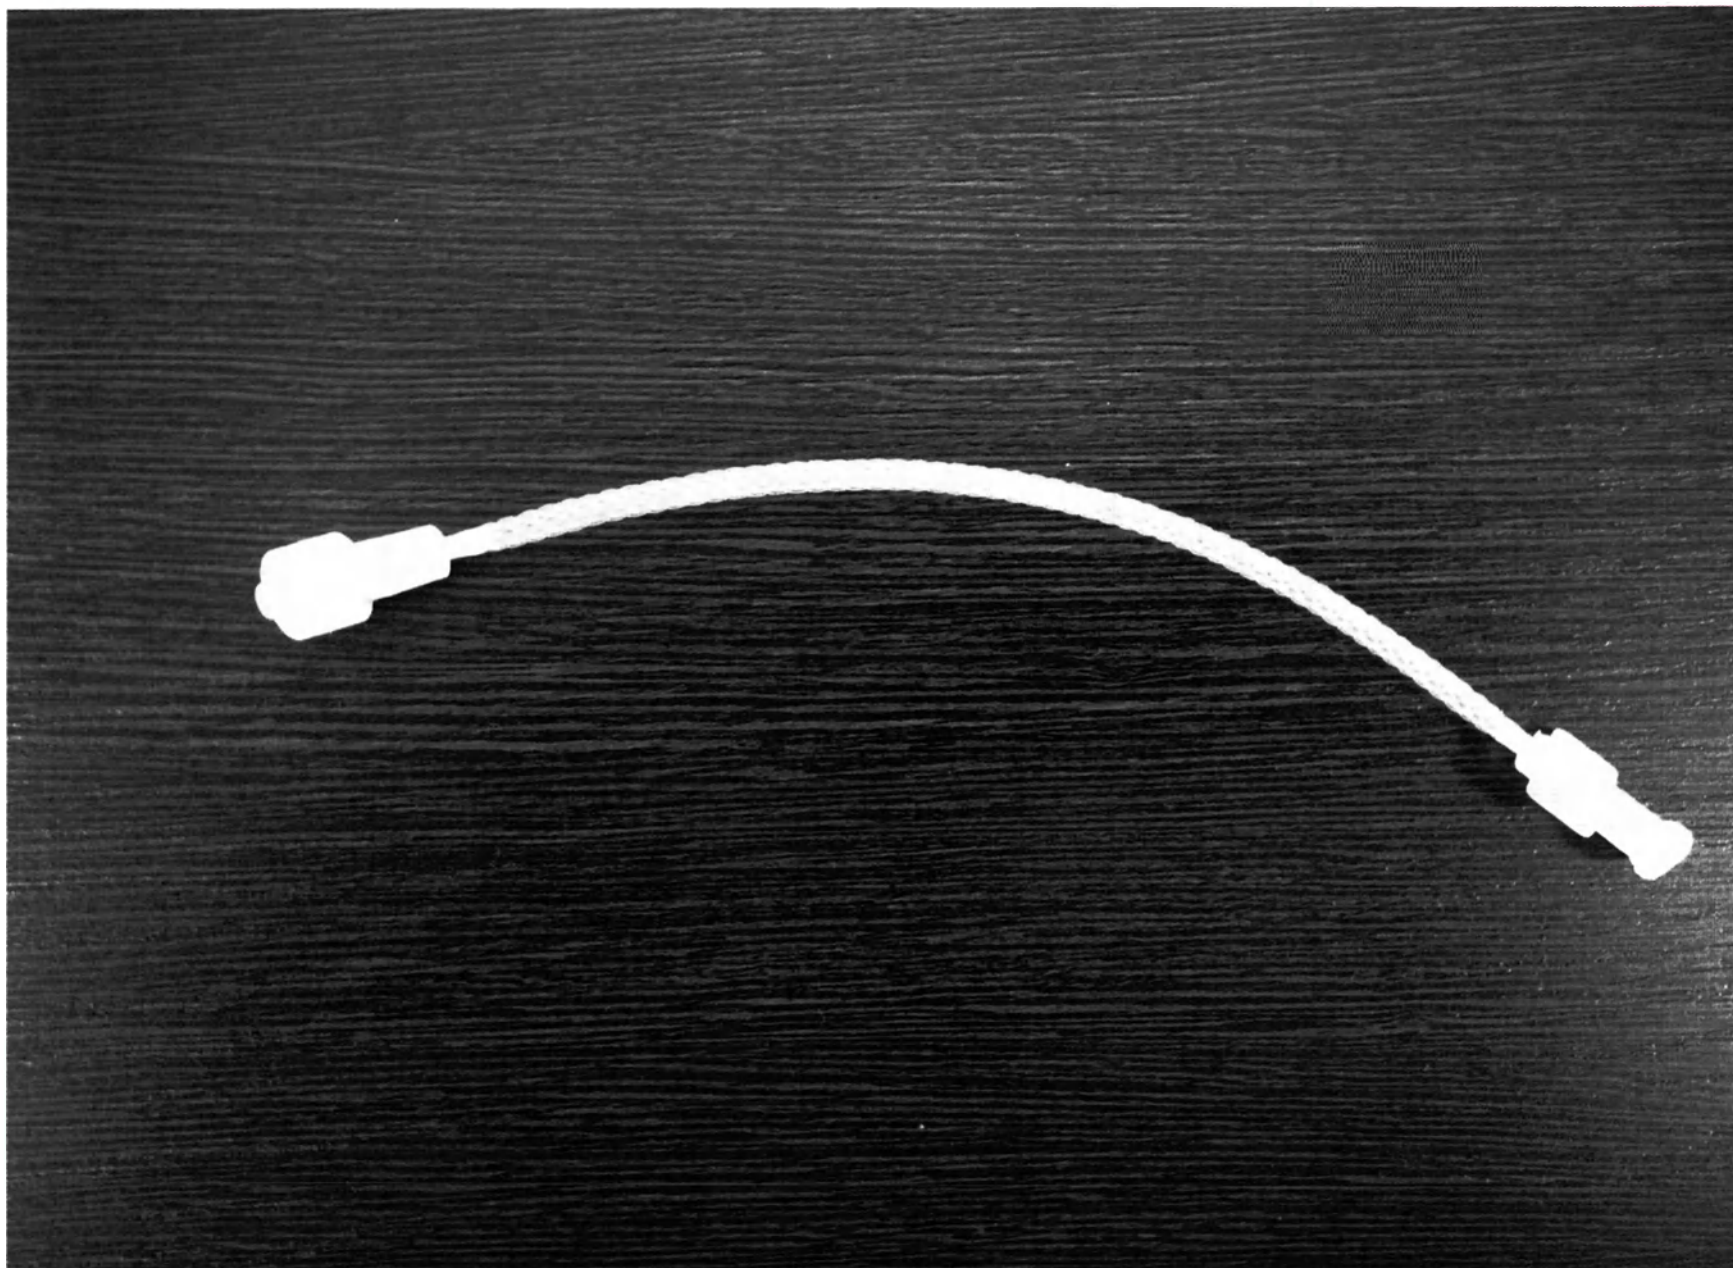


Линия отбора проб CO₂ для взрослых

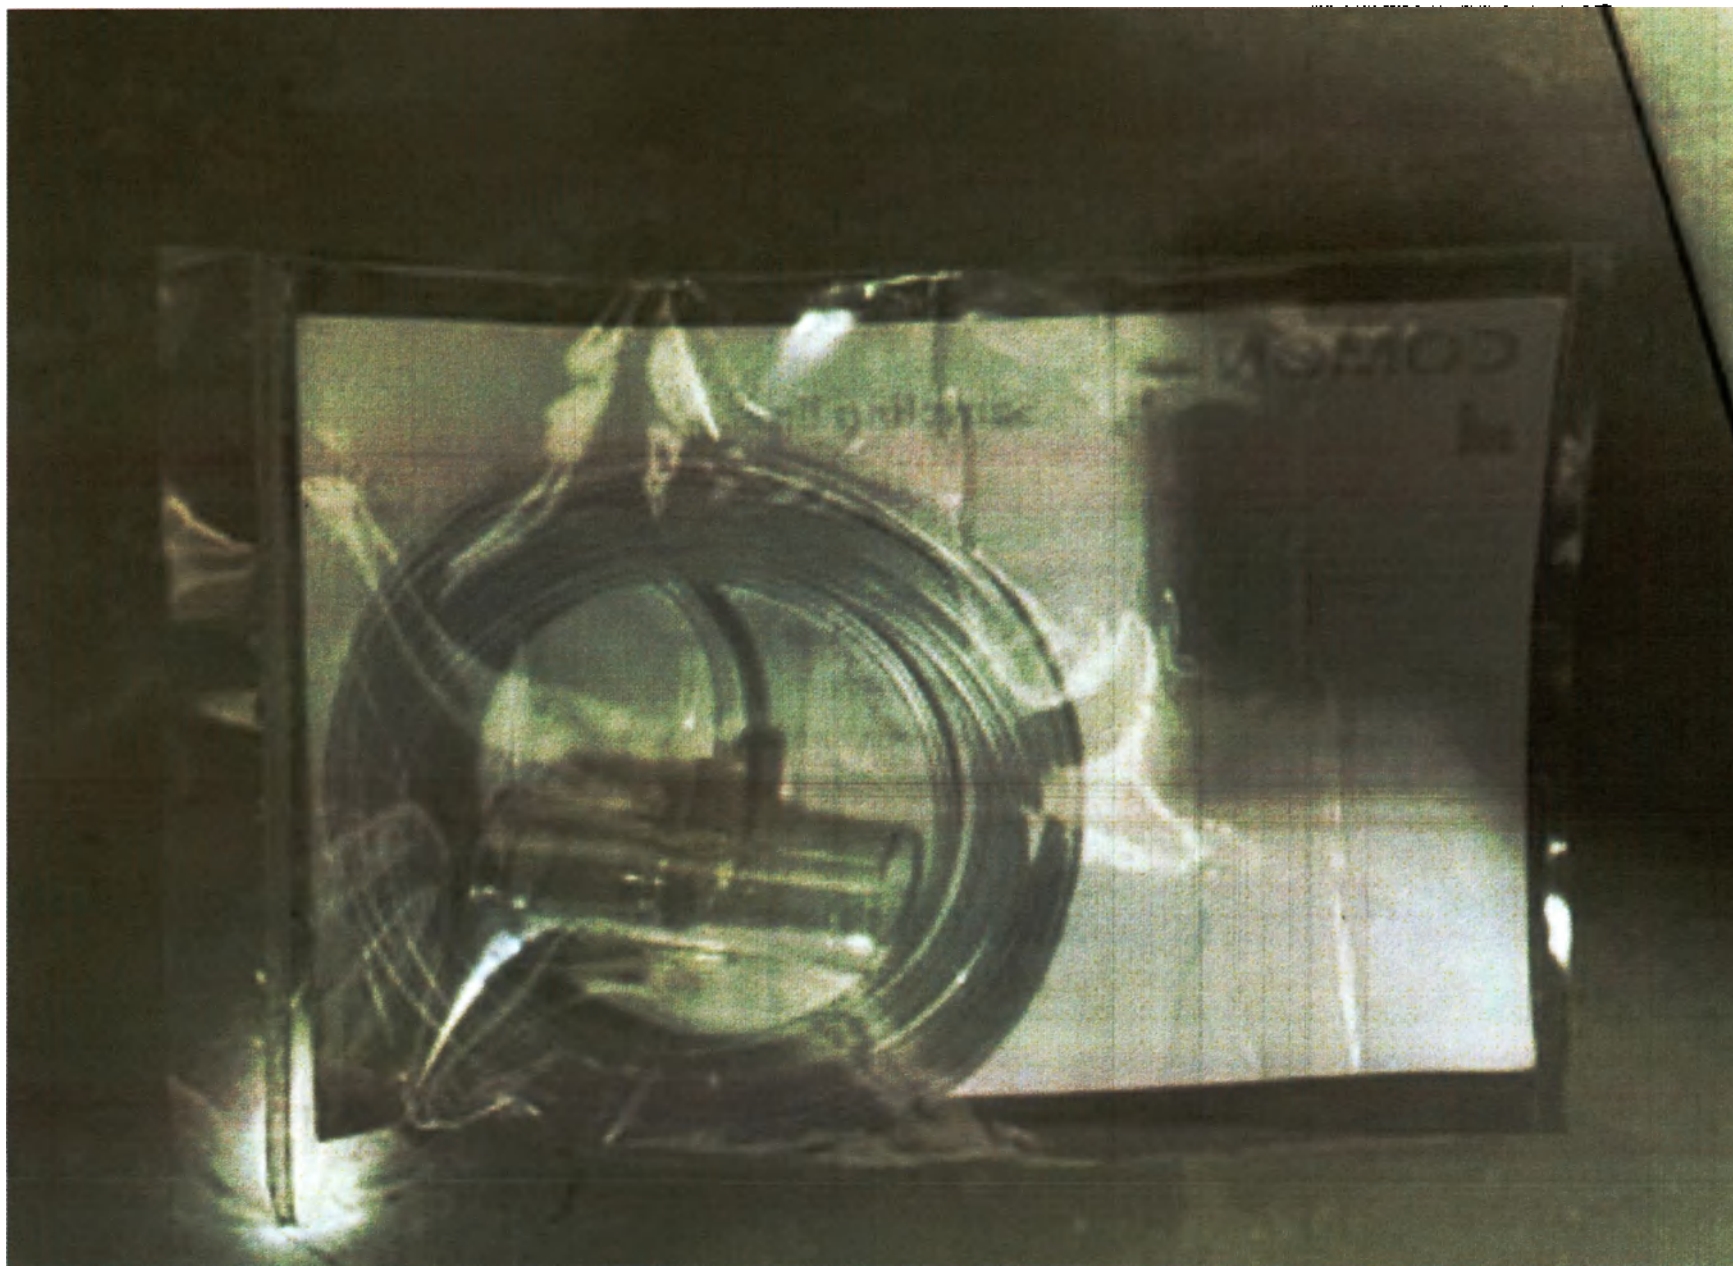

Линия отбора проб CO₂ для детей

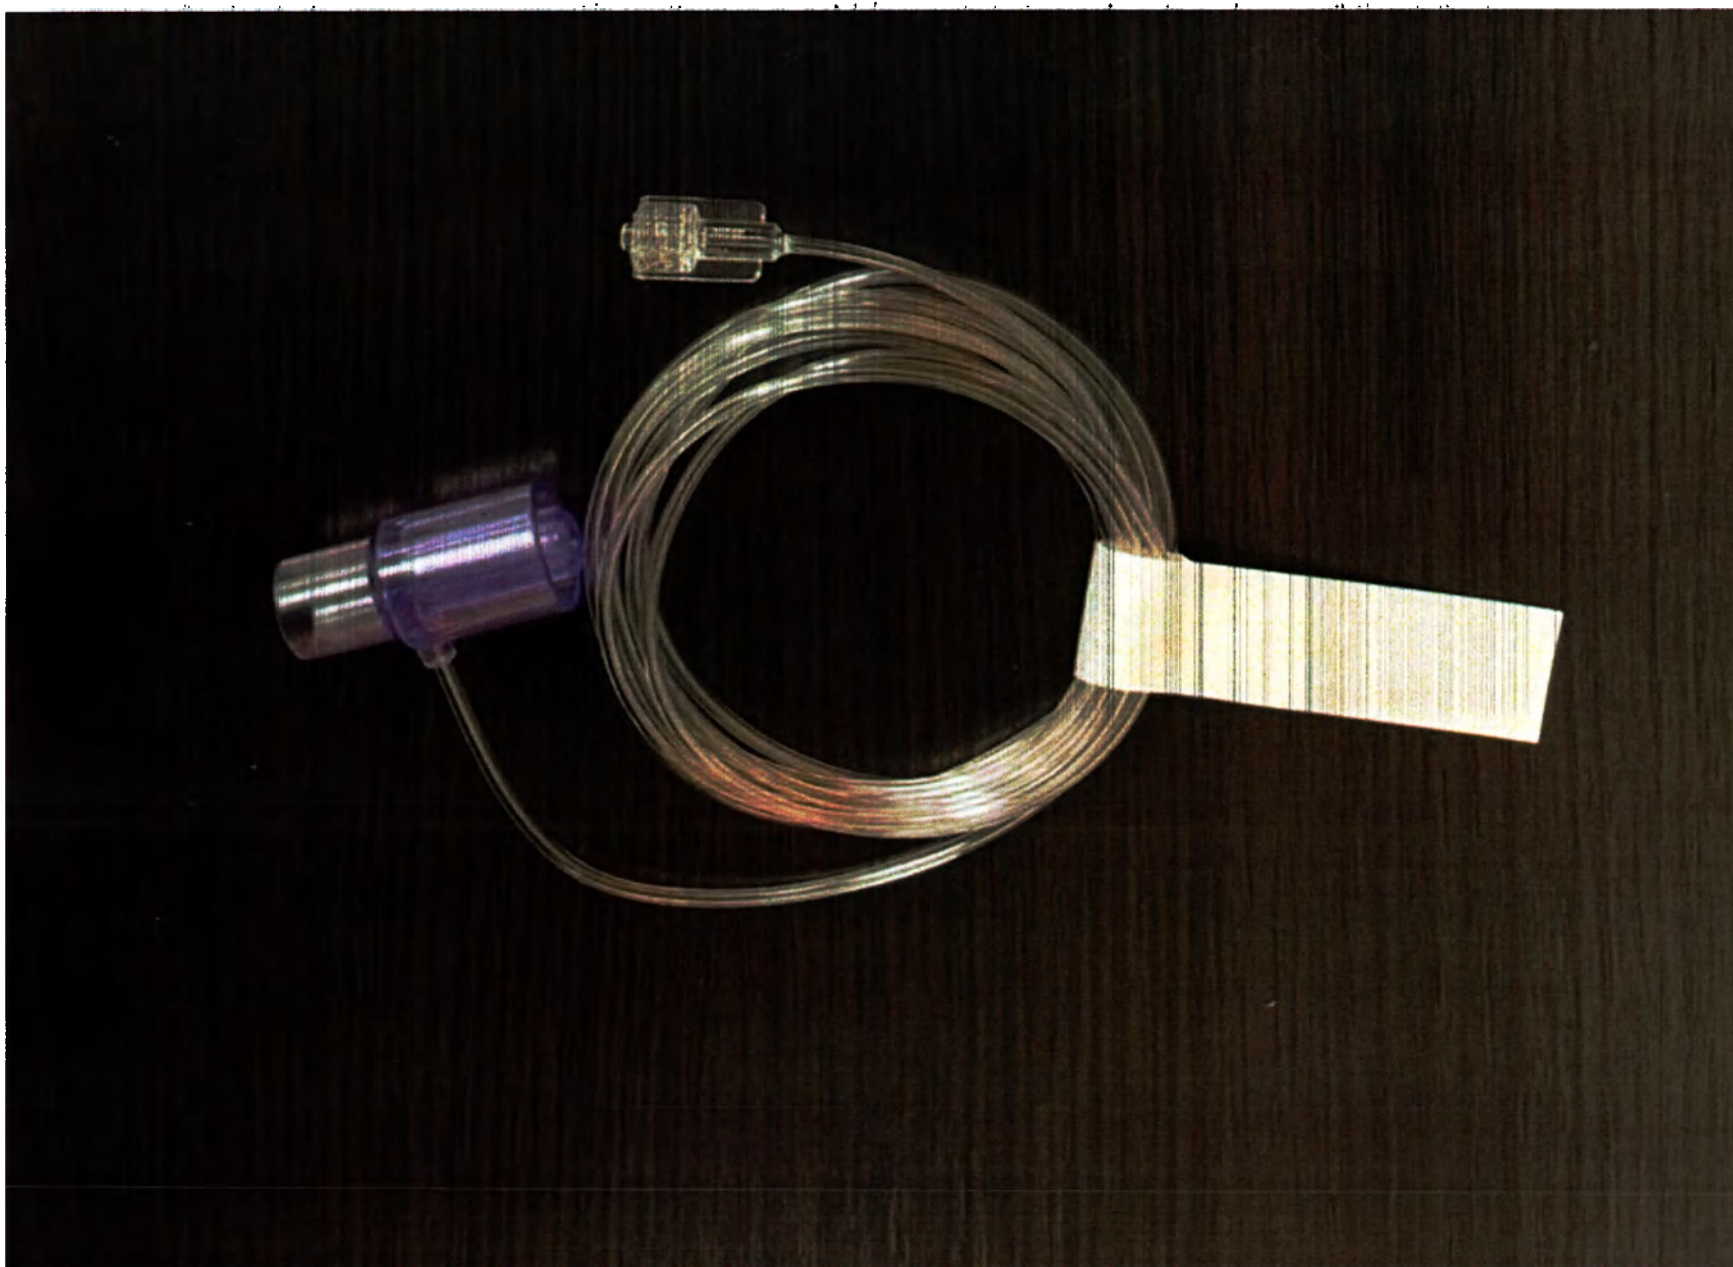

Назальная канюля для взятия пробы CO₂ для взрослых

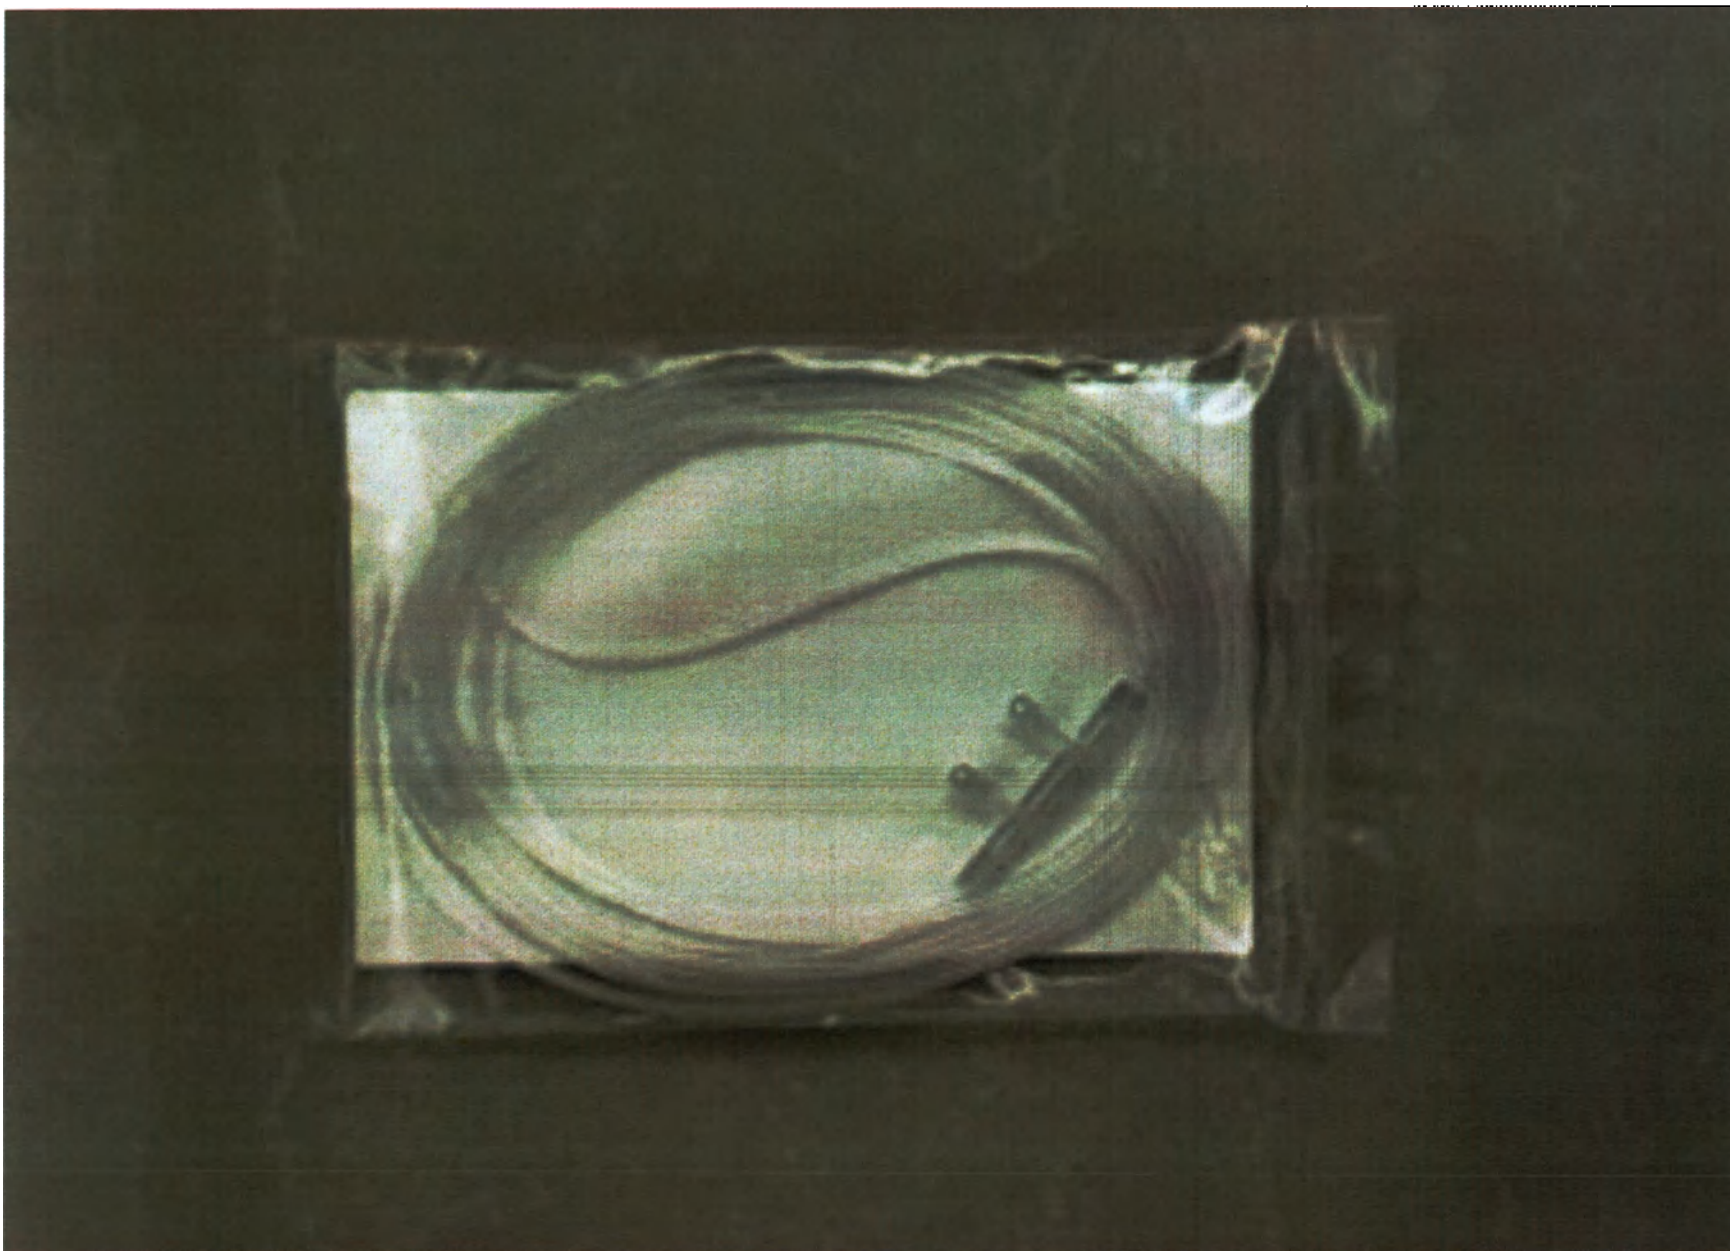

Назальная канюля для взятия пробы CO₂ для детей



Линия отбора проб газа для взрослых 3m



Модуль CO₂ основного потока, «Комен»



Адаптер для взрослых



Адаптер для детей




Интегрируемый модуль CO2 бокового потока




Интегрируемый модуль АГ бокового потока для анестезирующего газ




Интегрируемый модуль ИАД

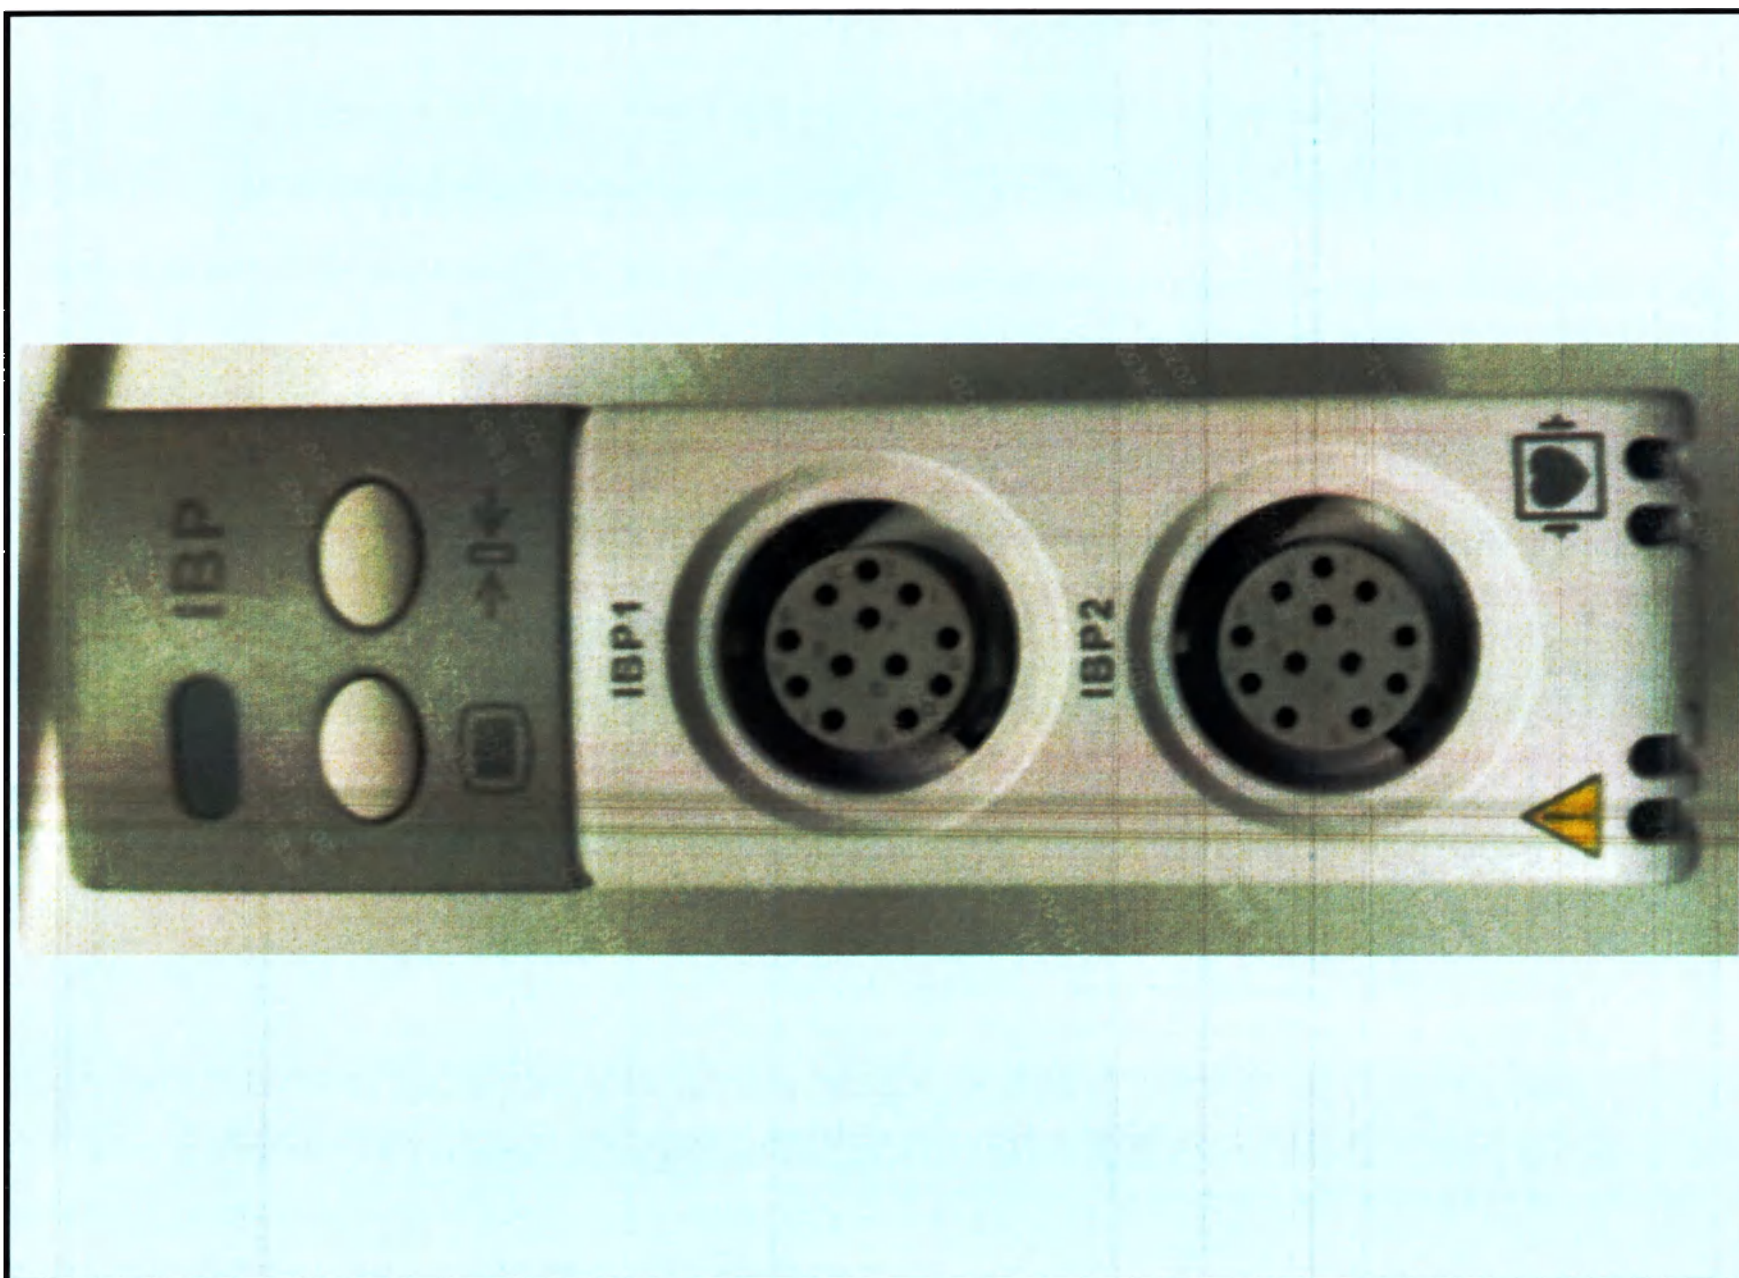

Интегрируемый модуль ИКТ

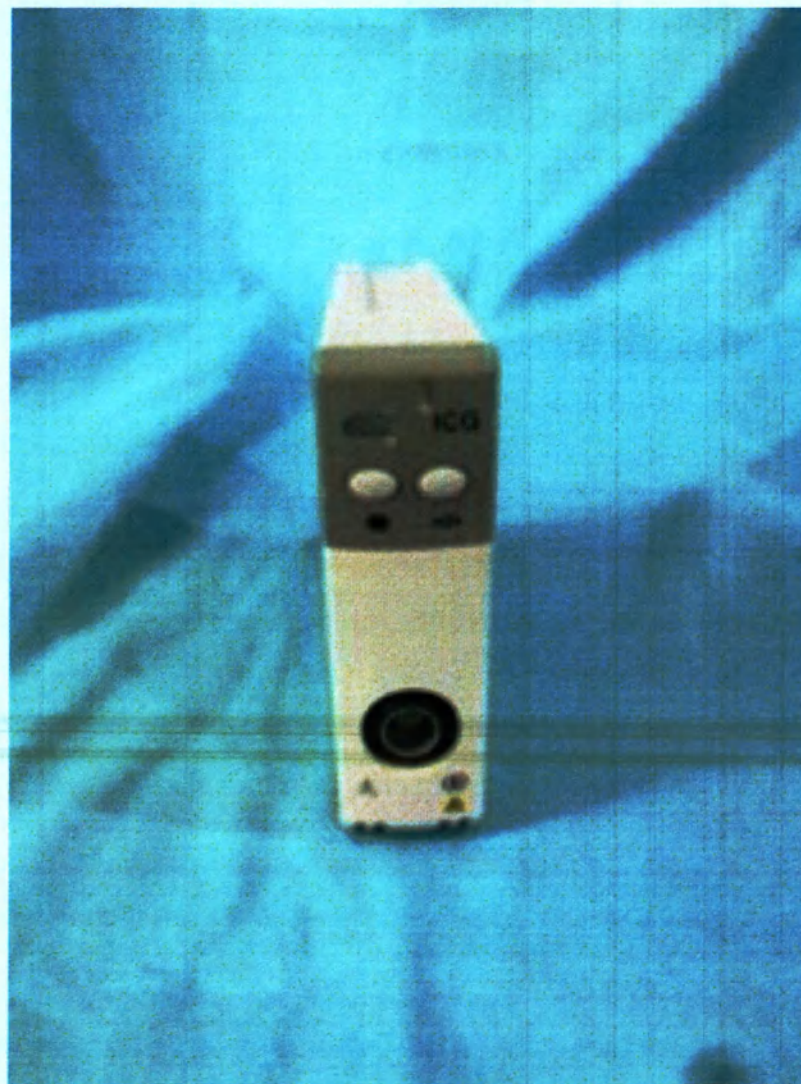


Кабель ИКТ, модель 7020-0416

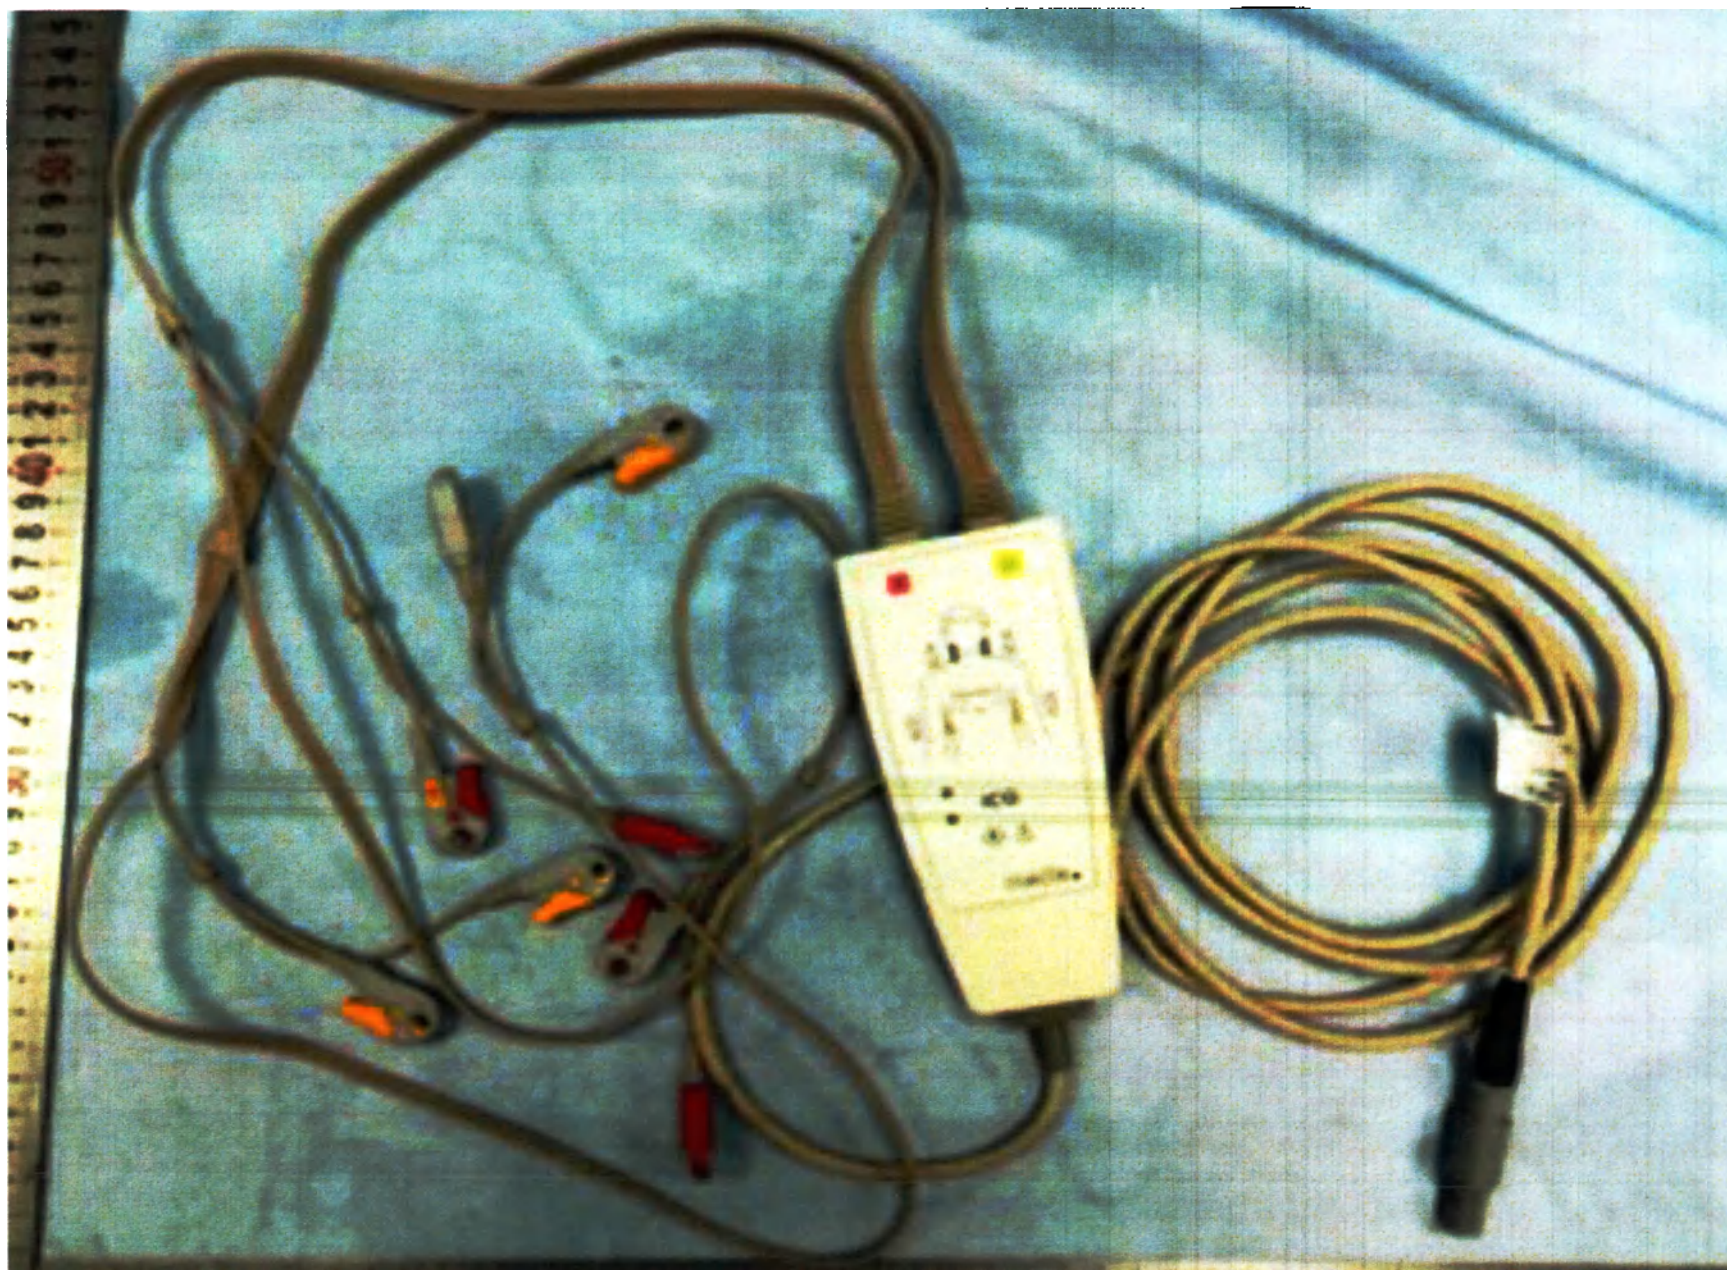

Электрод ИКТ, модель N1201-5




Интегрируемый модуль сердечного выброса

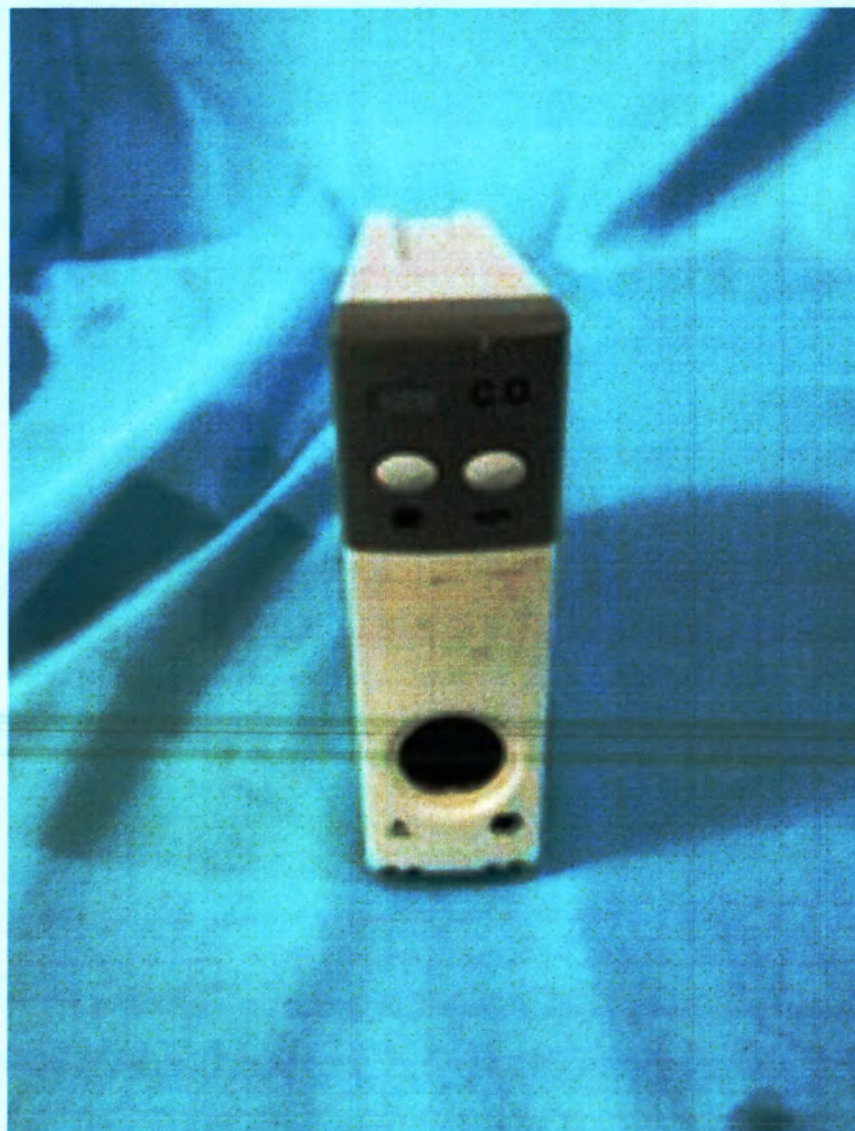


Кабель сердечного выброса, модель MC07-221200-01




Интегрируемый модуль апноэ пробуждения

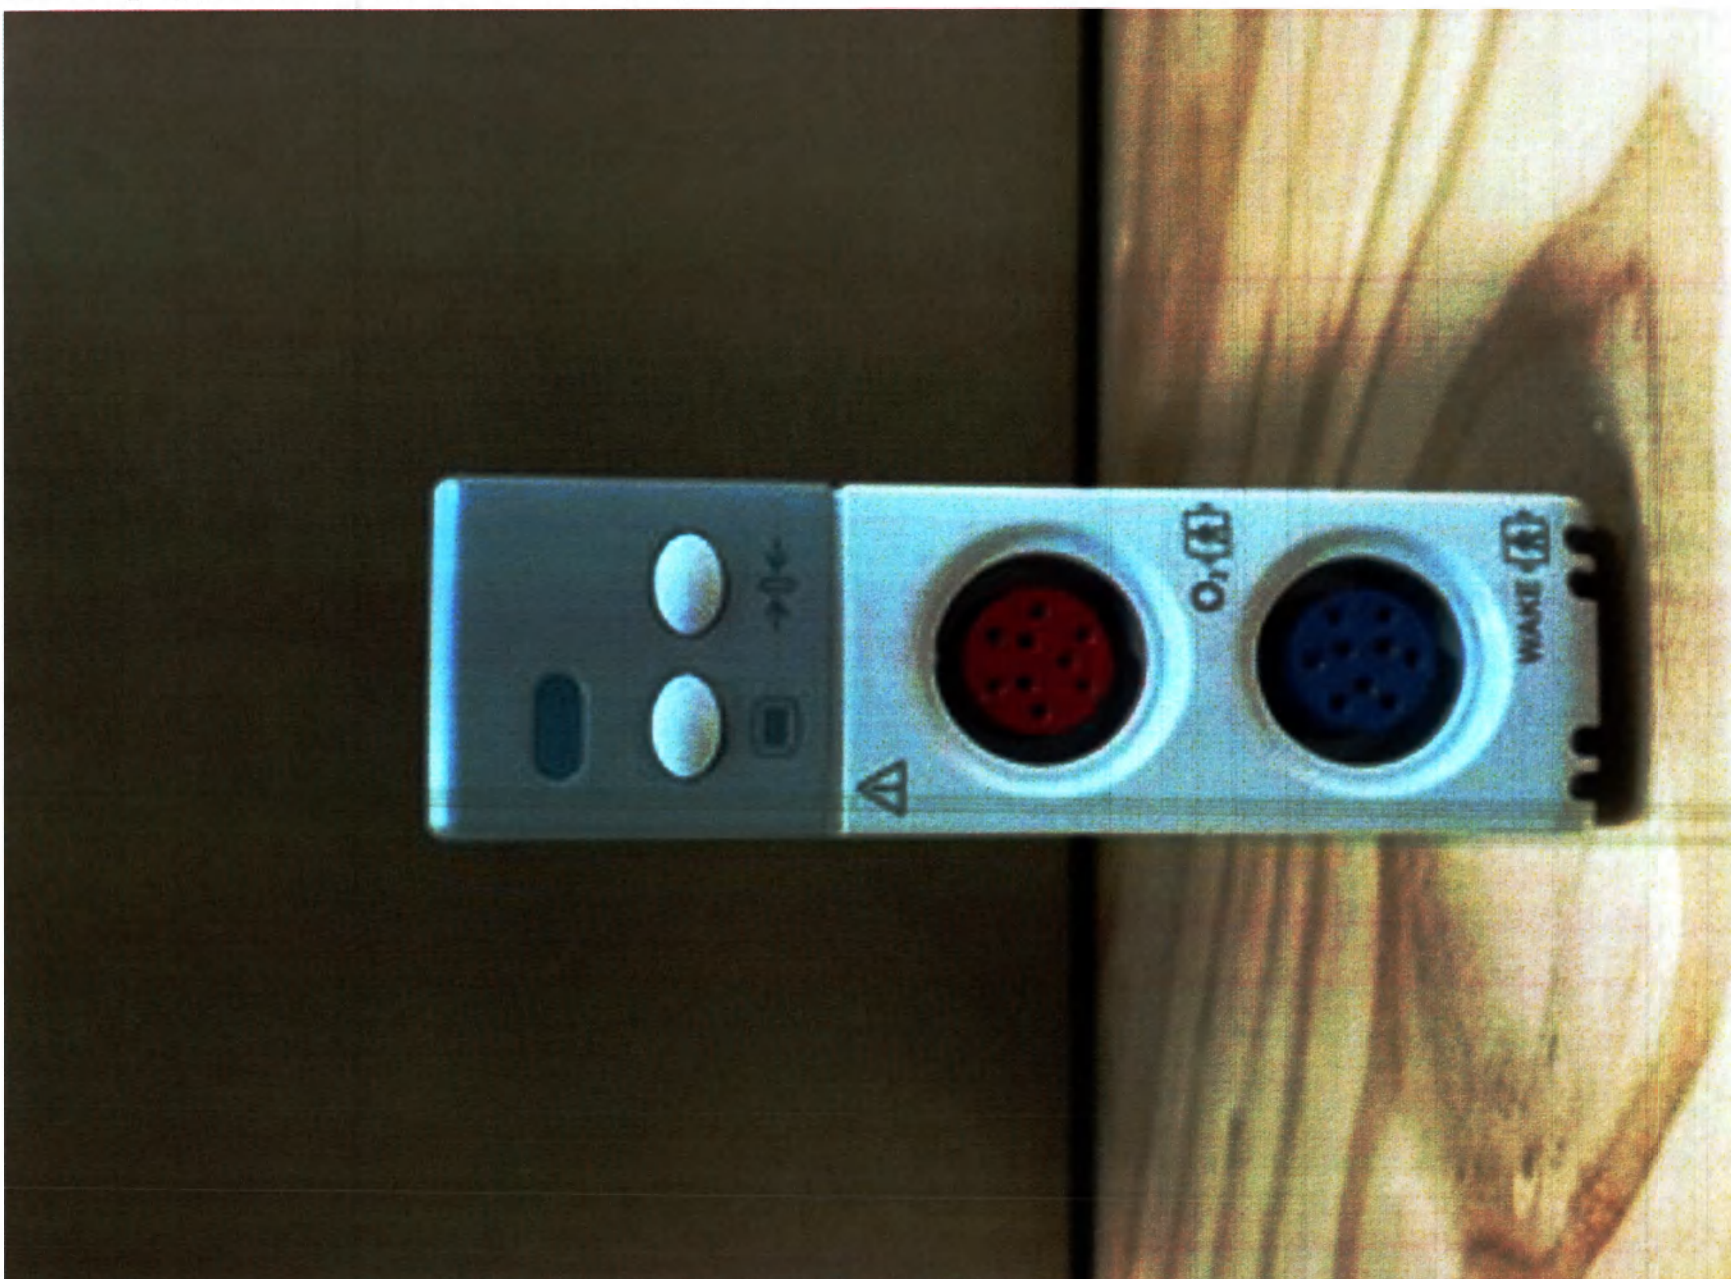

Датчик пробуждения новорожденных при АПНОЭ

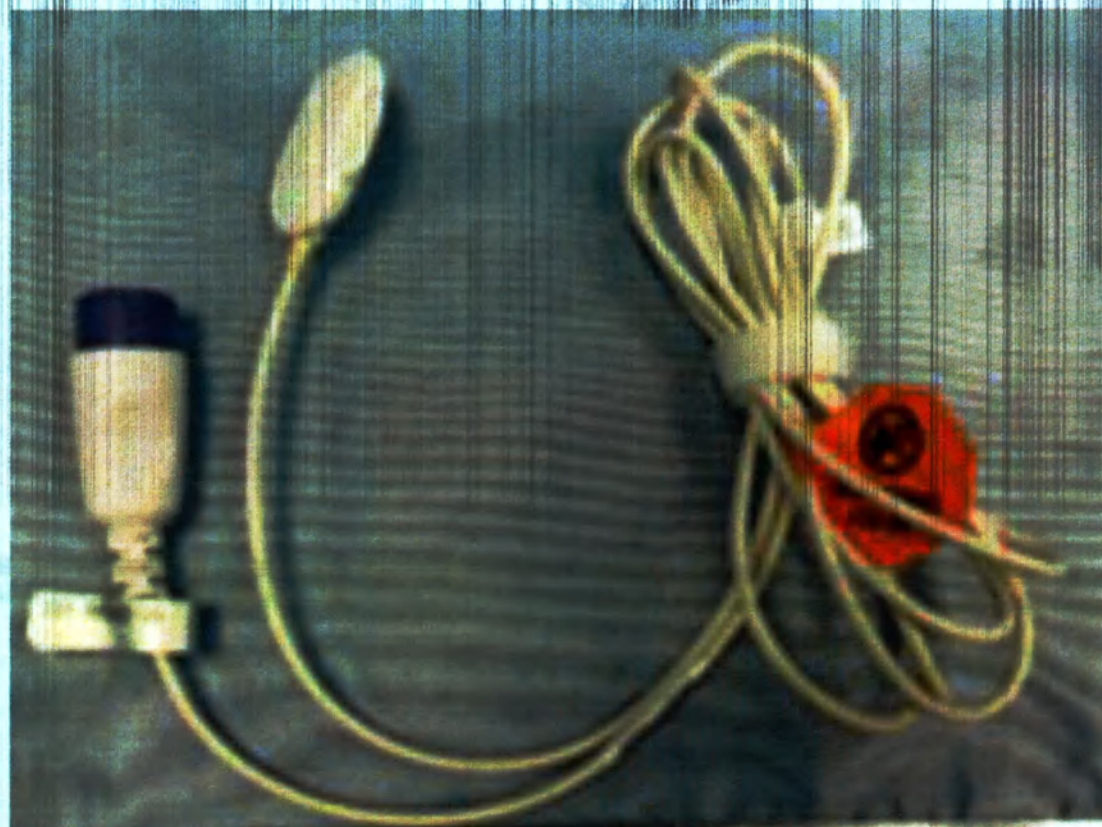


Соединительный кабель для датчика концентрации кислорода

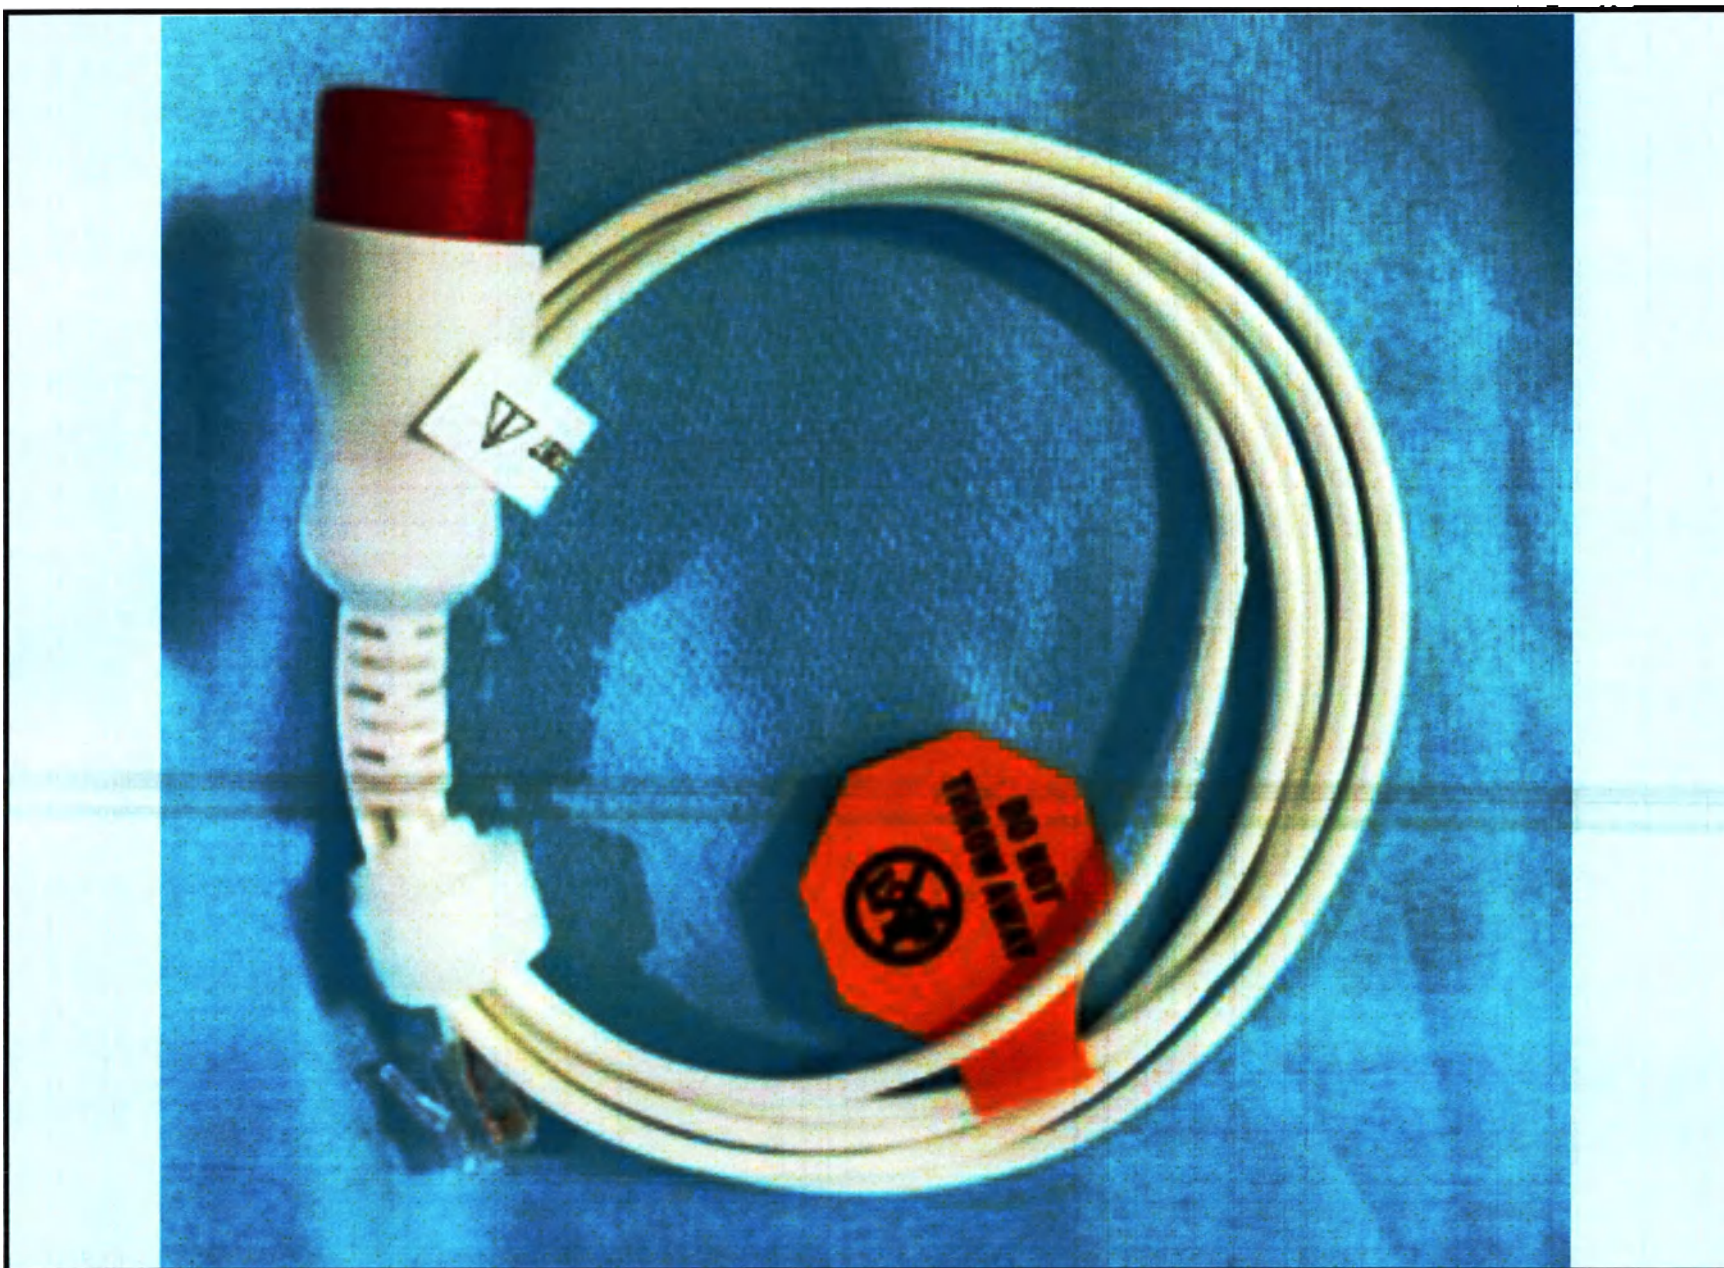


Датчик концентрации кислорода, модель MOX-3




Интегрируемый модуль капнометрии в основном потоке

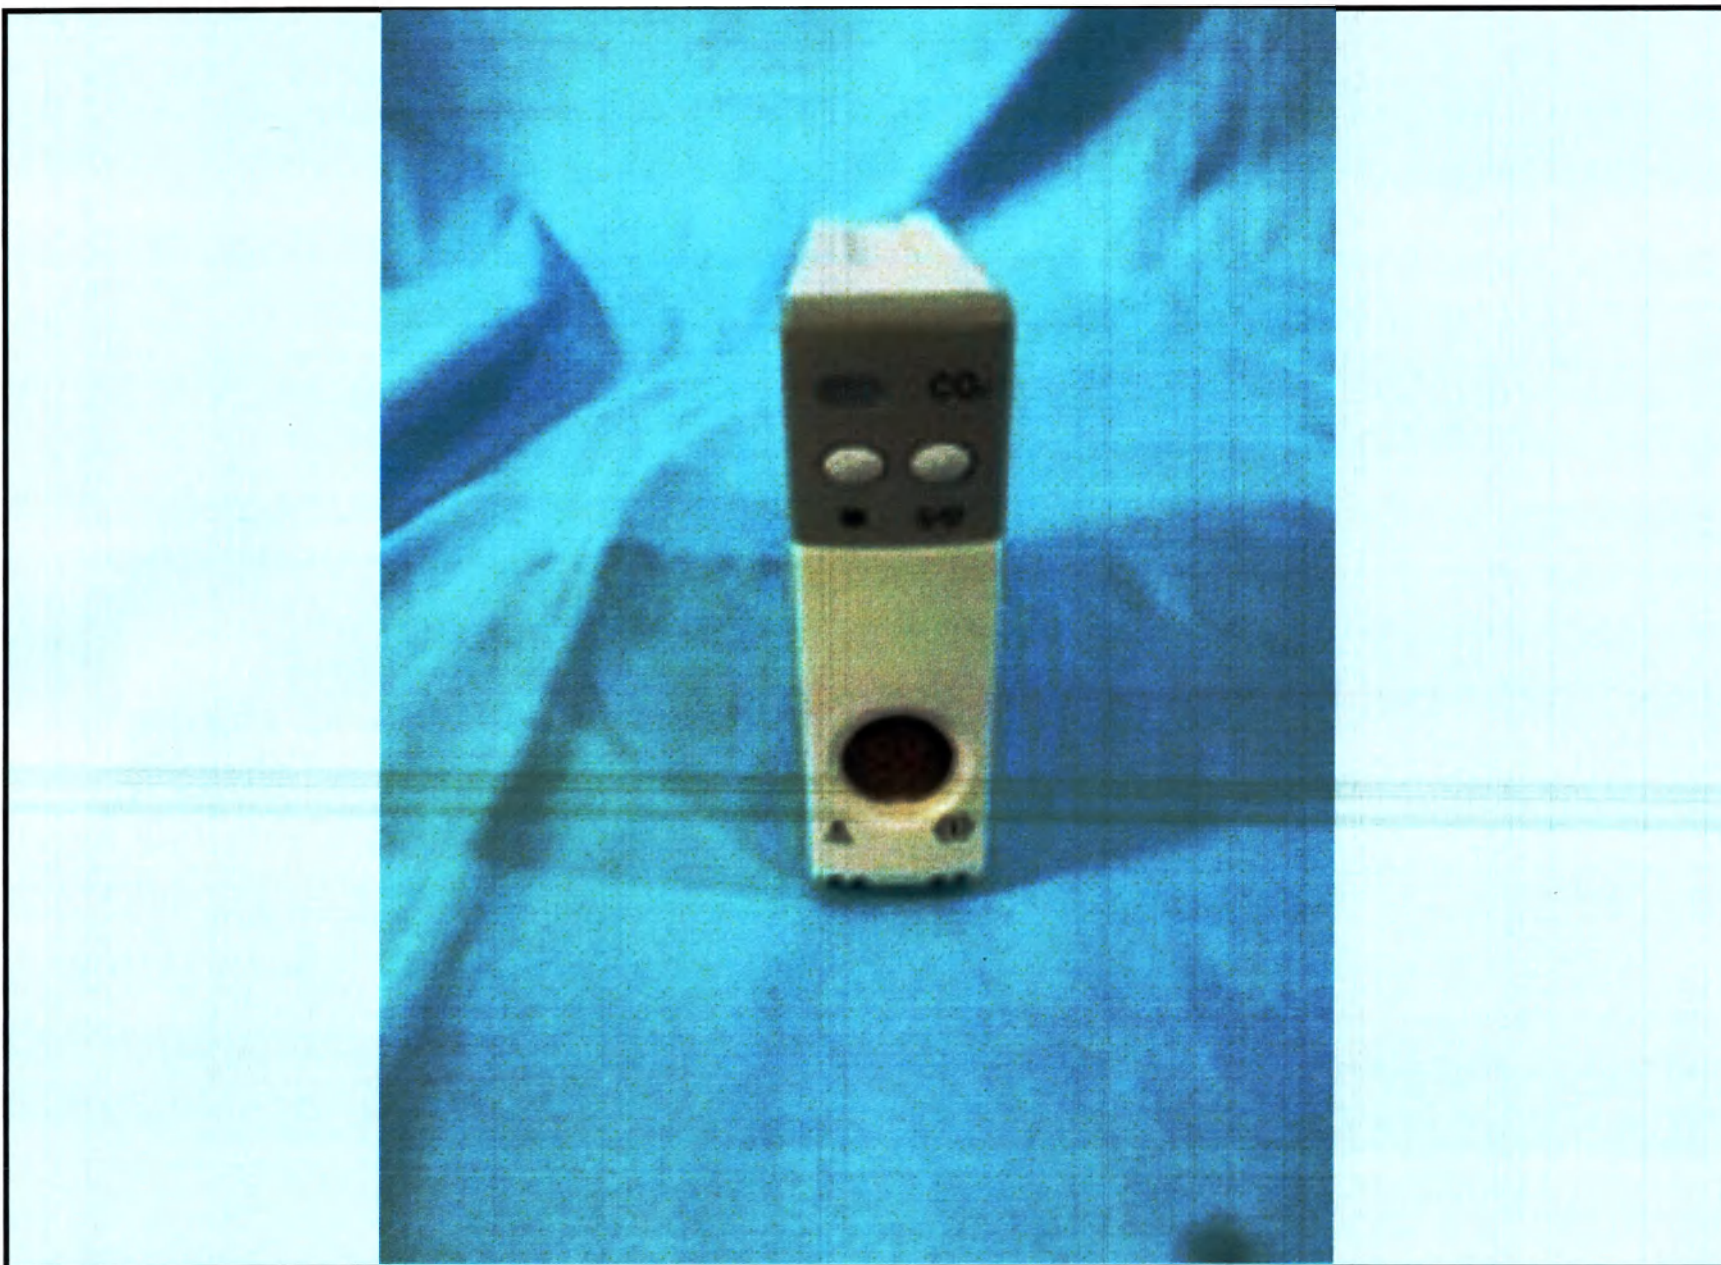


Интегрируемый модуль анестезиологических газов в основном потоке

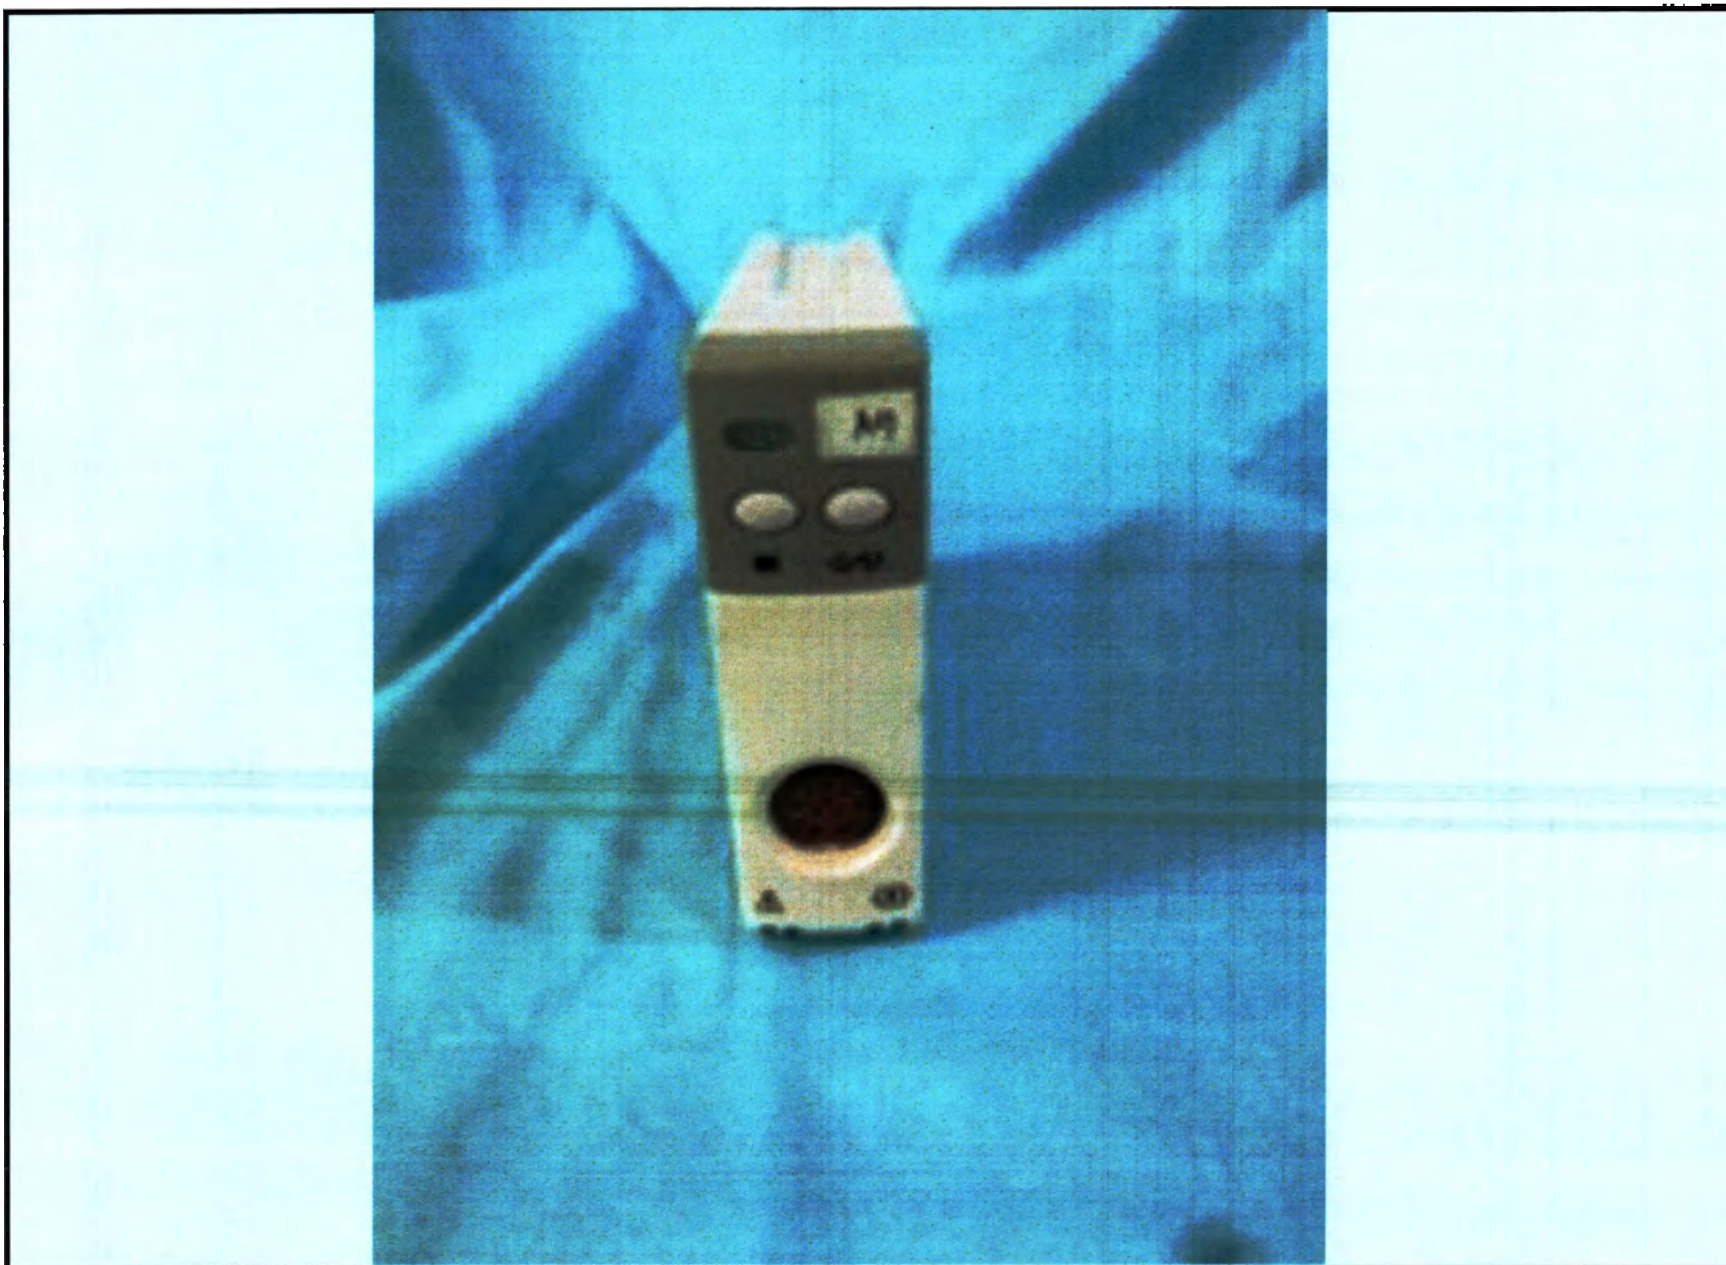

Модуль анестезиологических газов

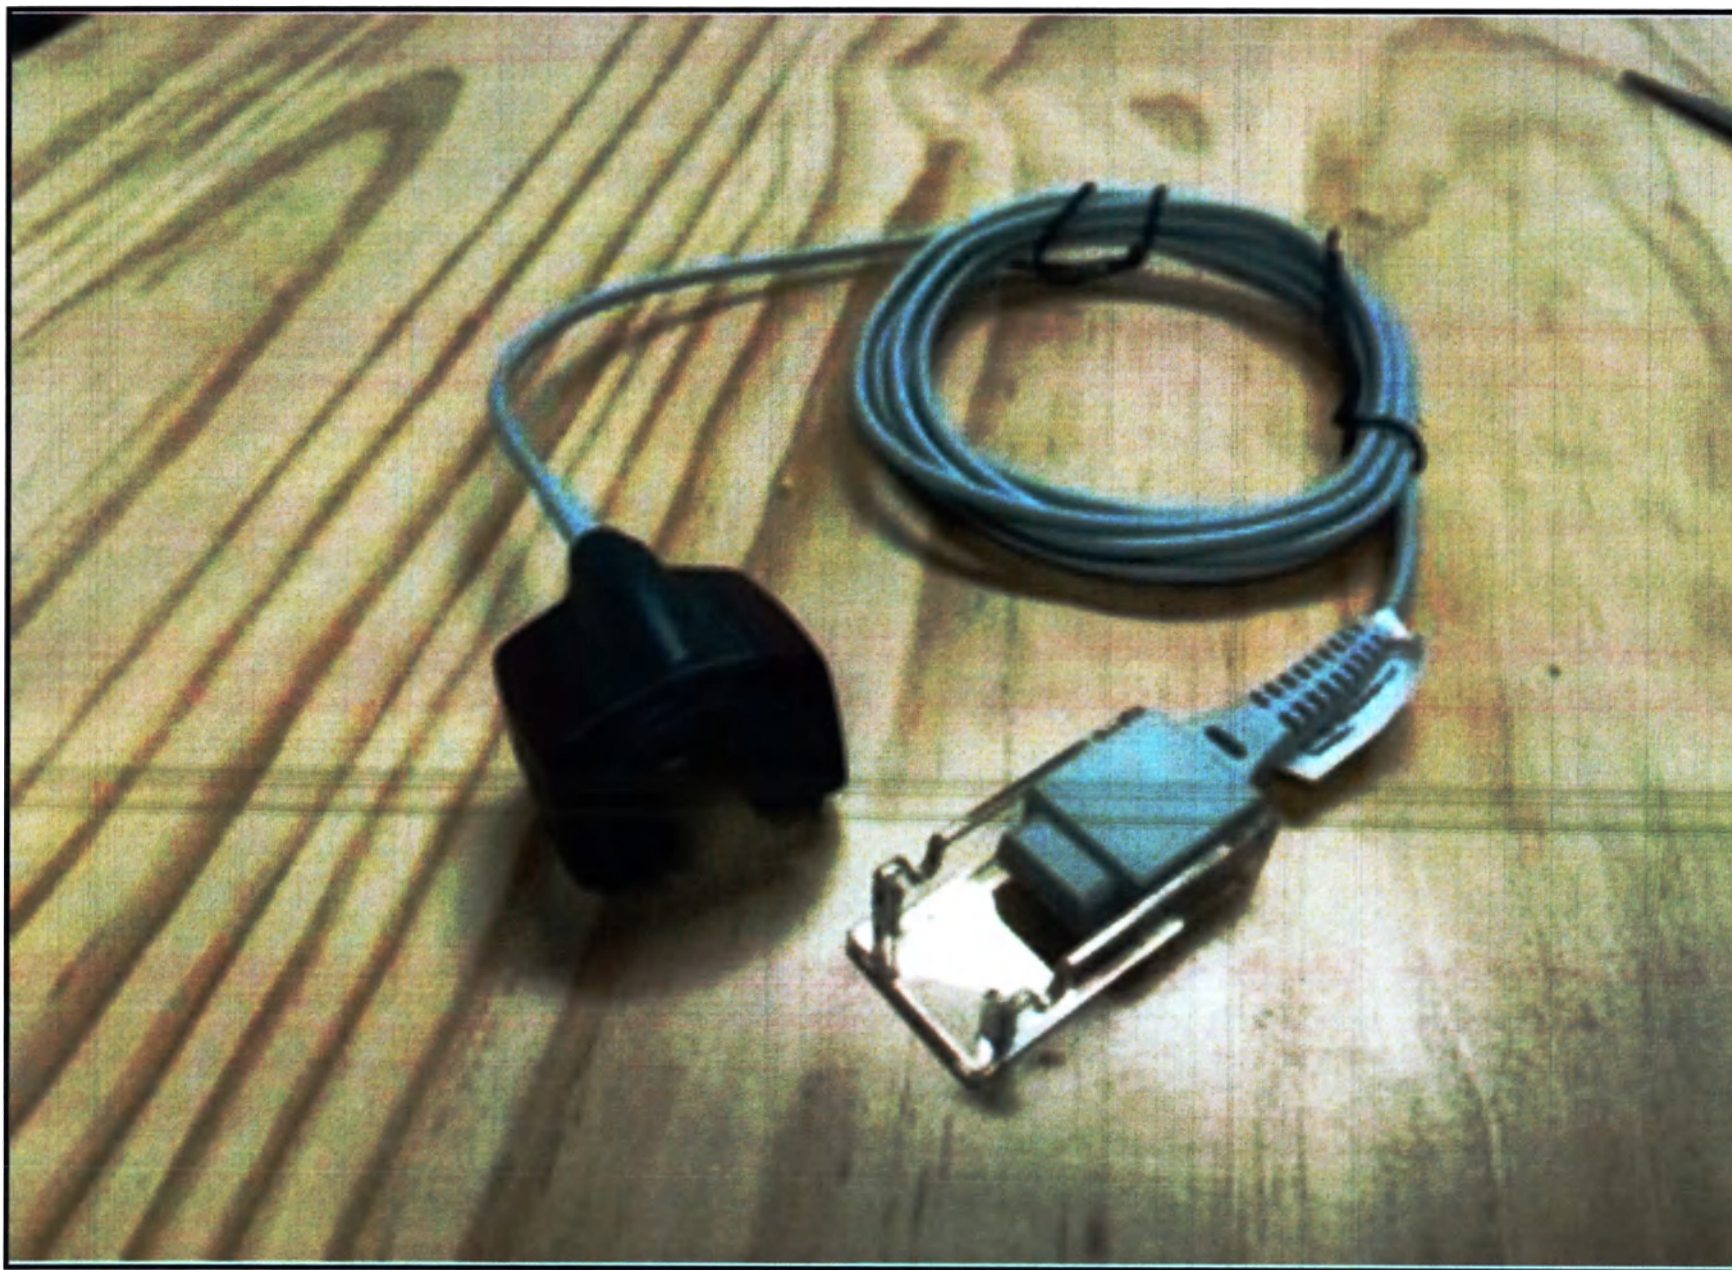


Интегрируемый модуль биспектрального индекса (BIS)

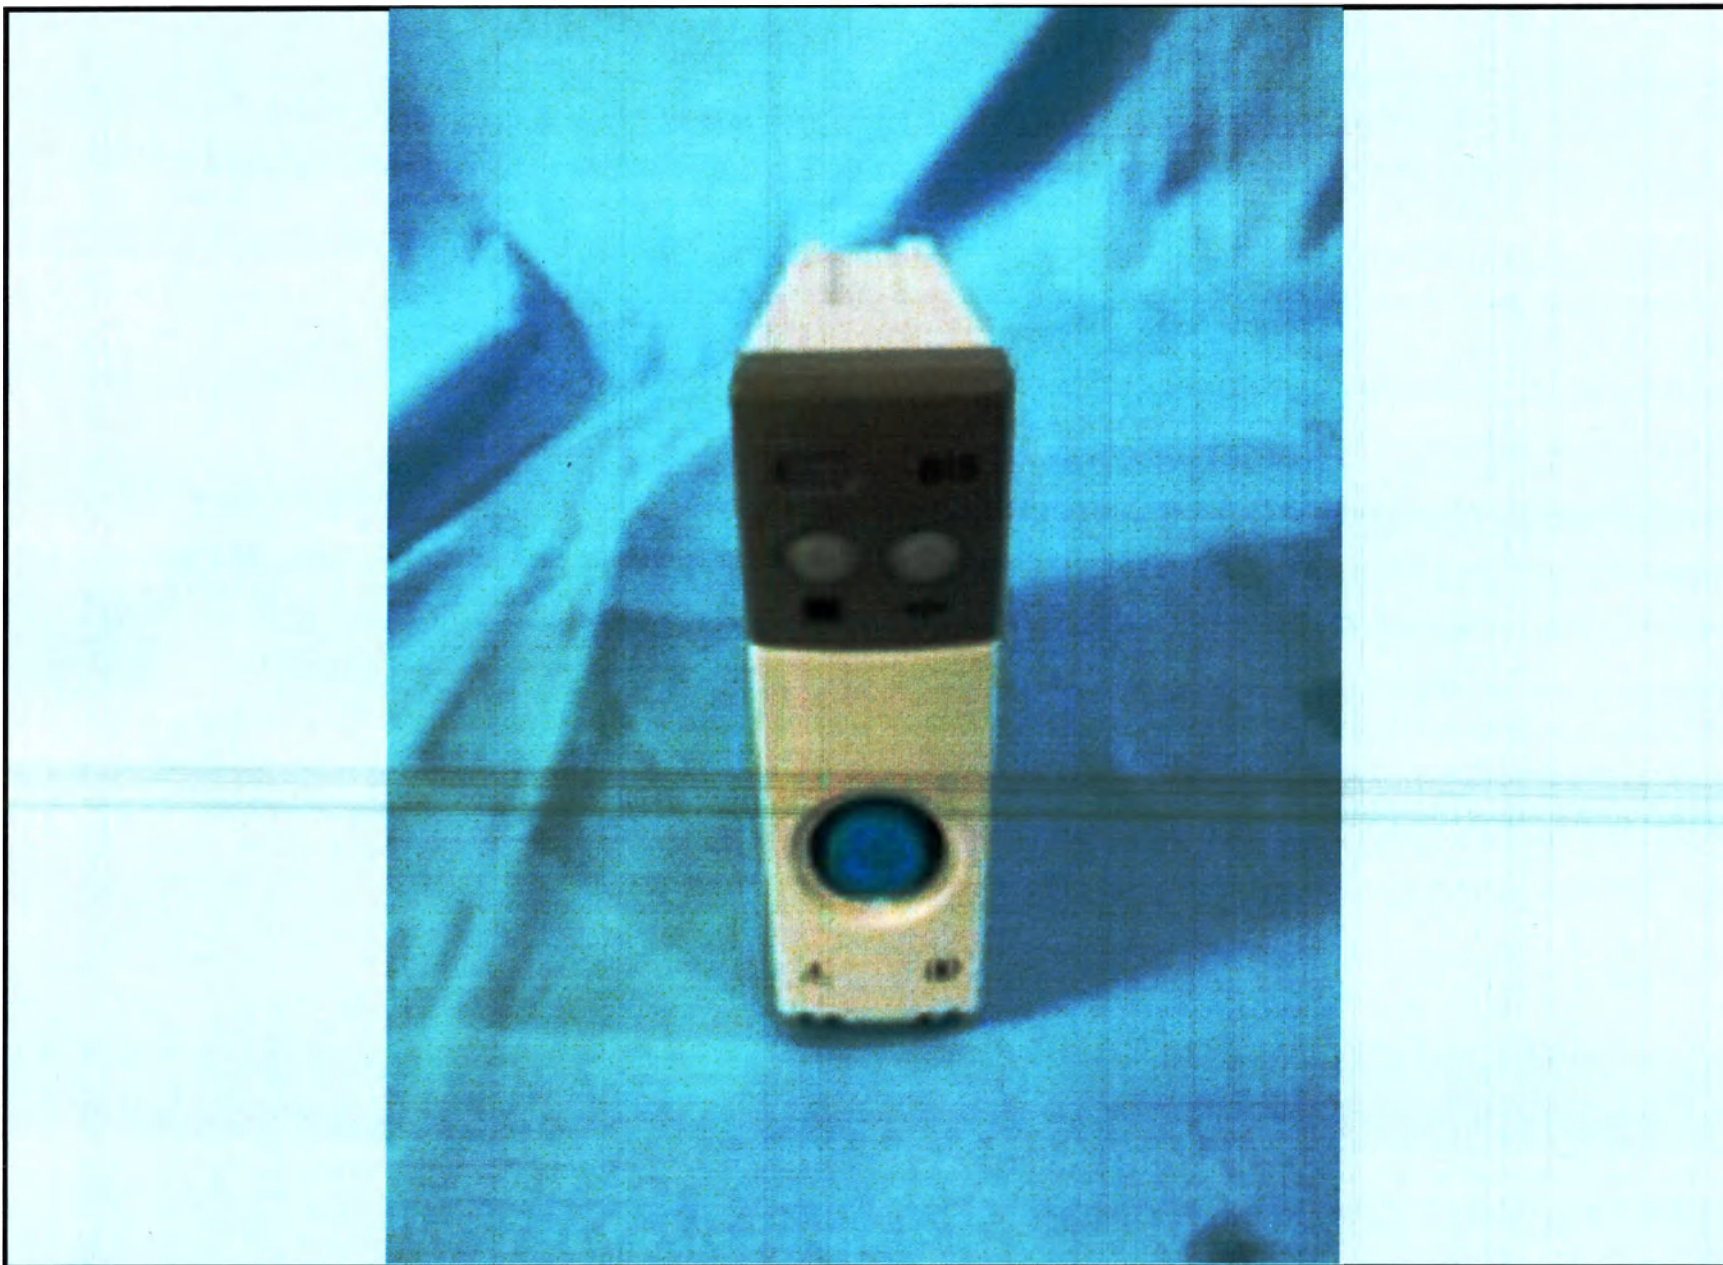


Модуль BIS, "КОВИДЕН"



4-электродный датчик BIS для взрослых, модель 186-0106

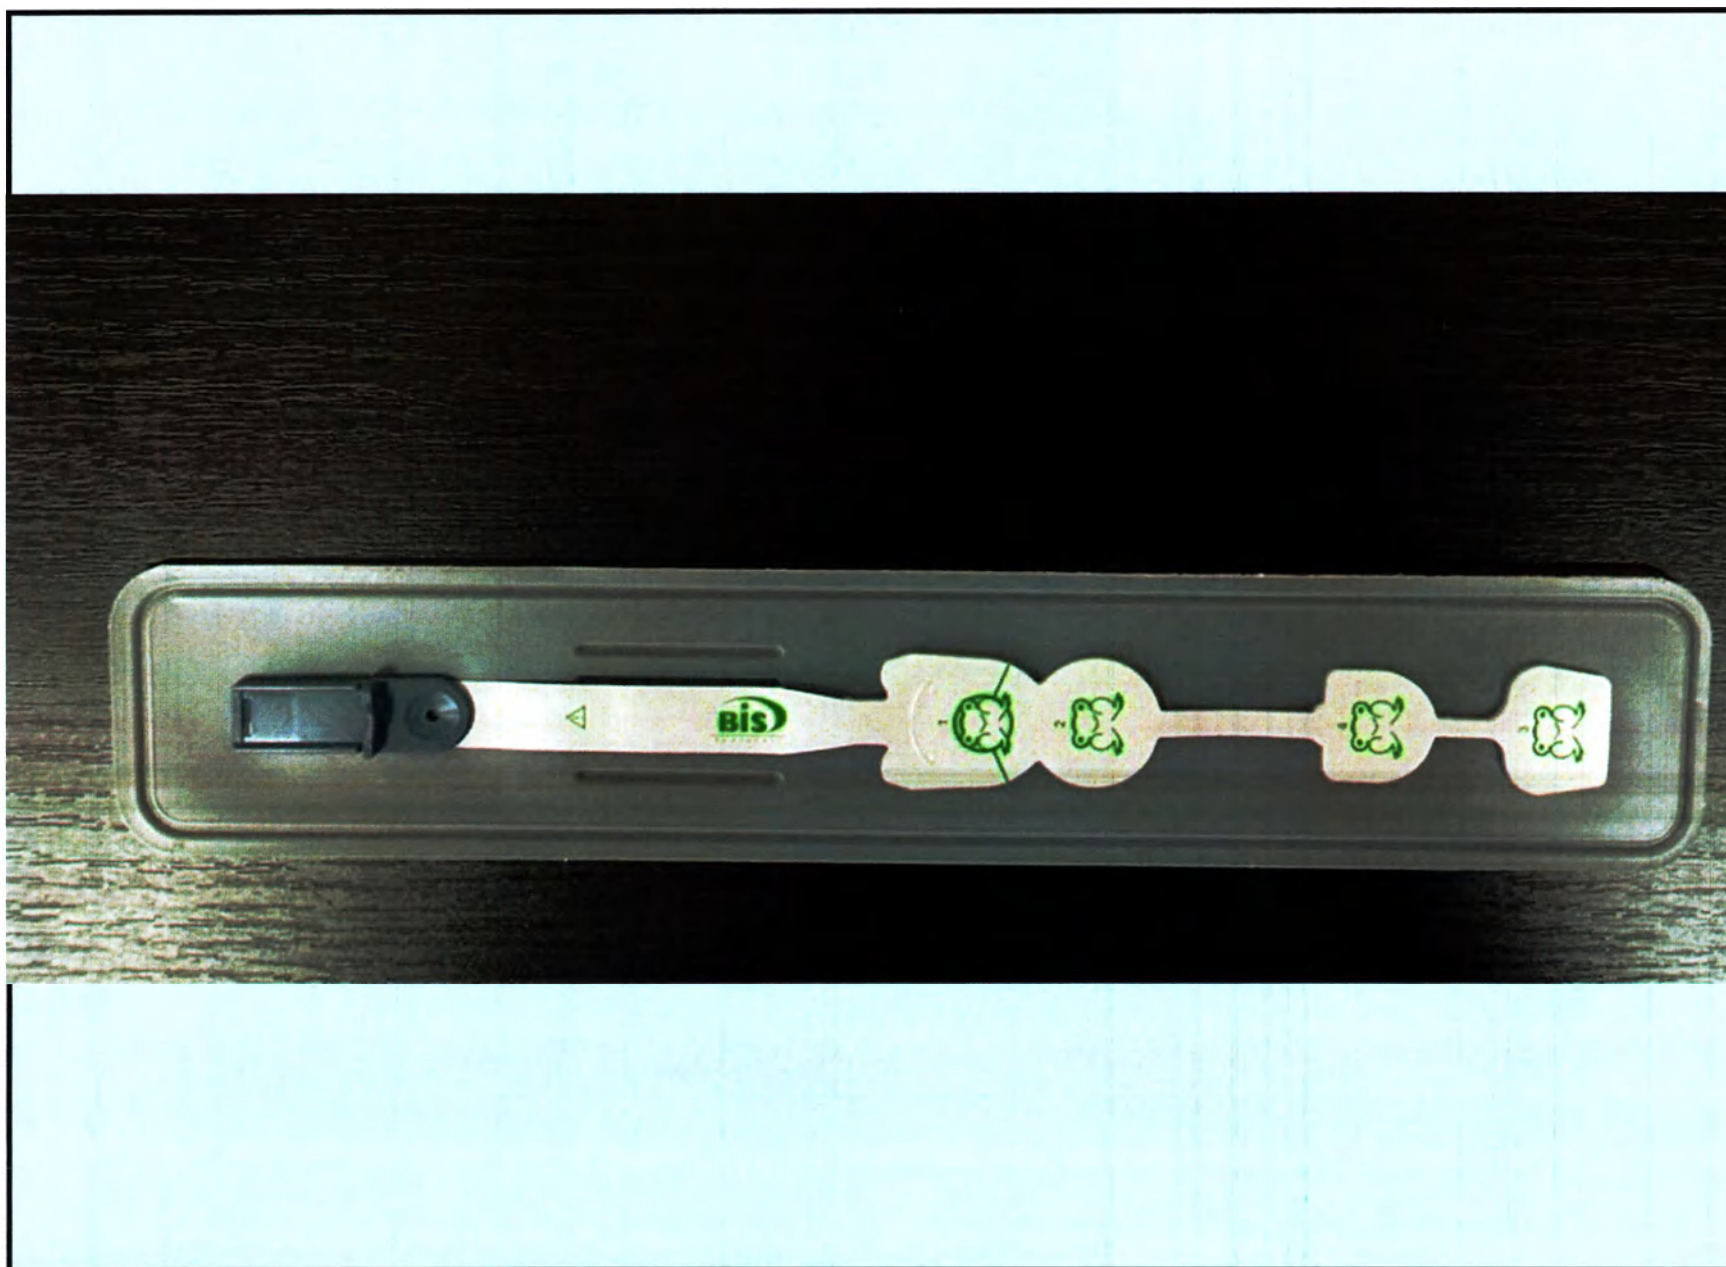

Интегрируемый модуль капнометрии в боковом потоке «Масимо»

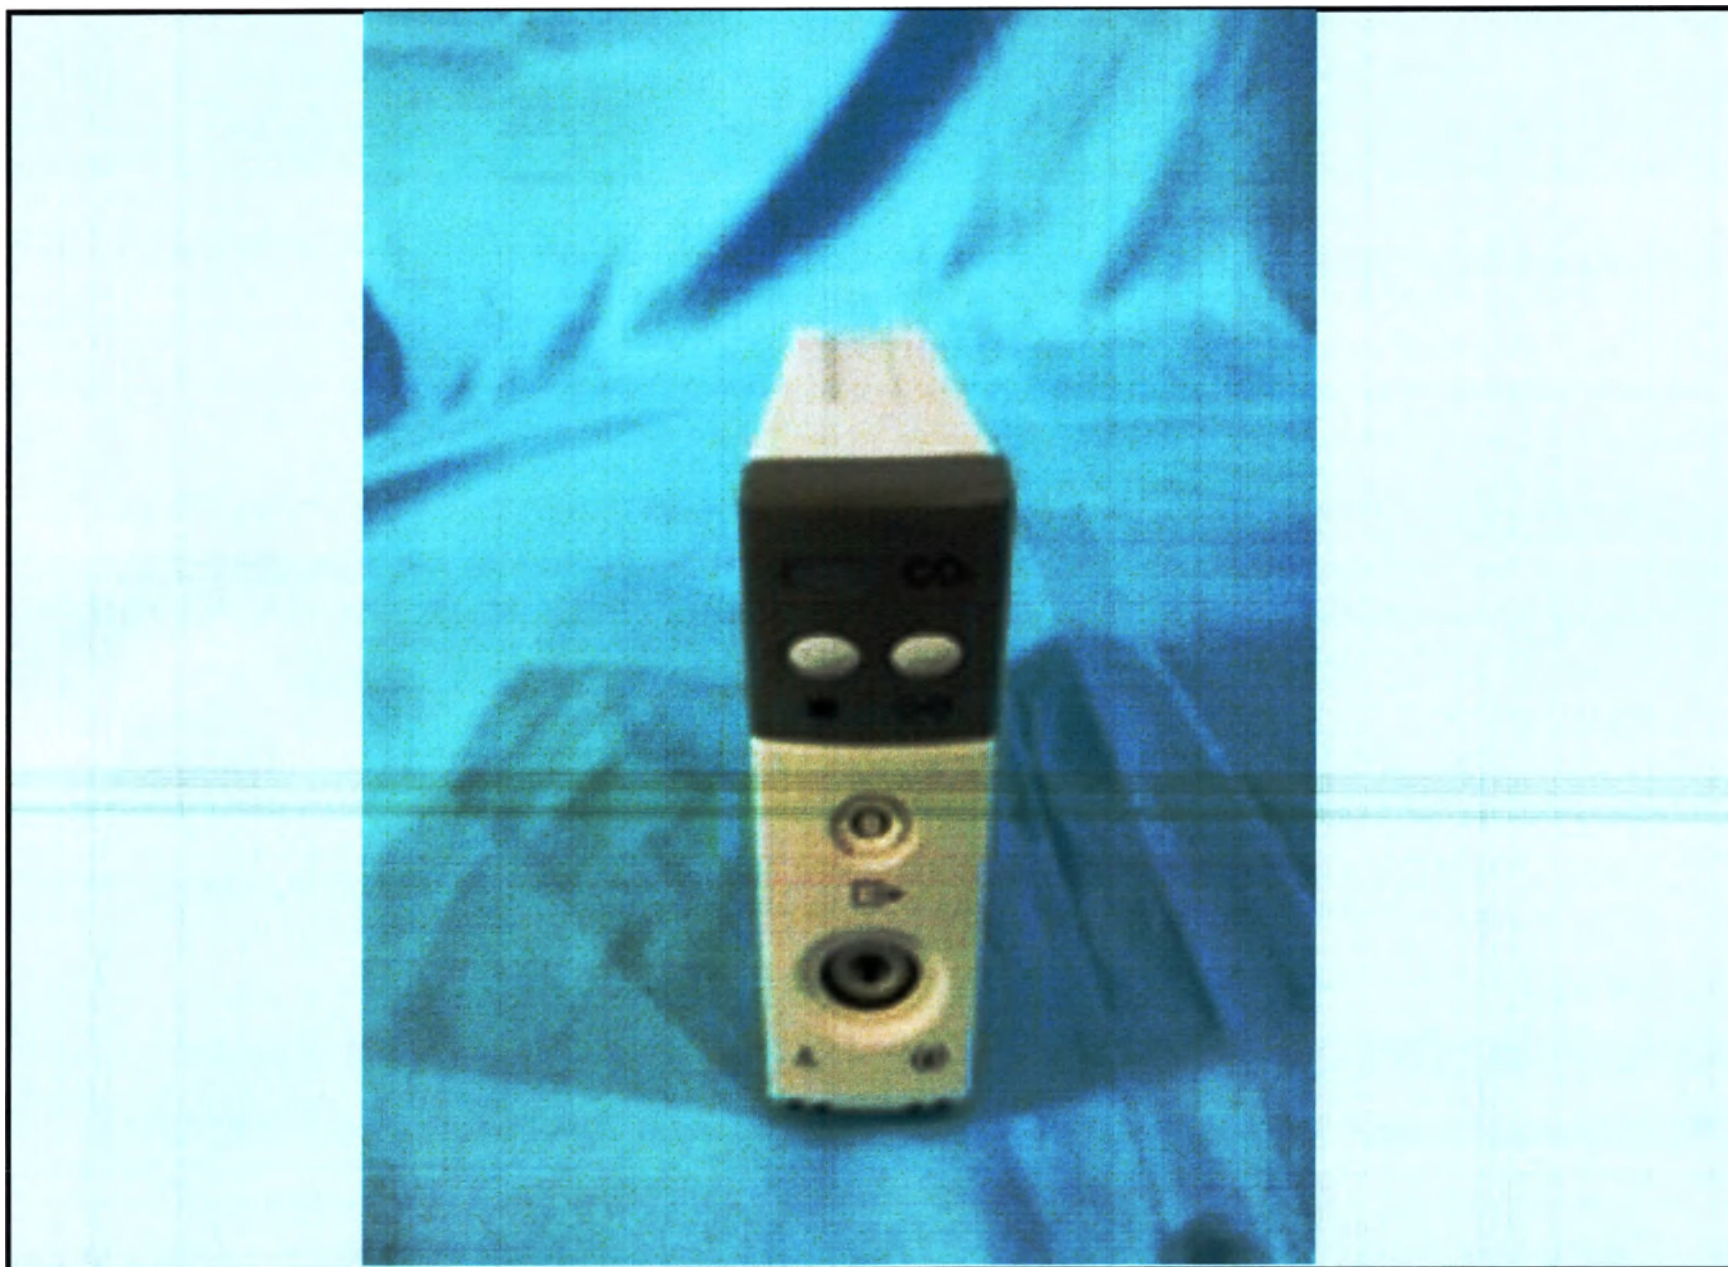

Вставной модуль измерения SpO2 «Масимо»




Кабель-удлинитель «Масимо»




(040-00000883)SpO2 датчик для взрослых, модель RD rainbow SET-2 Neo




(040-00000881)SpO2 датчик для взрослых, модель RD rainbow SET-2 Adt

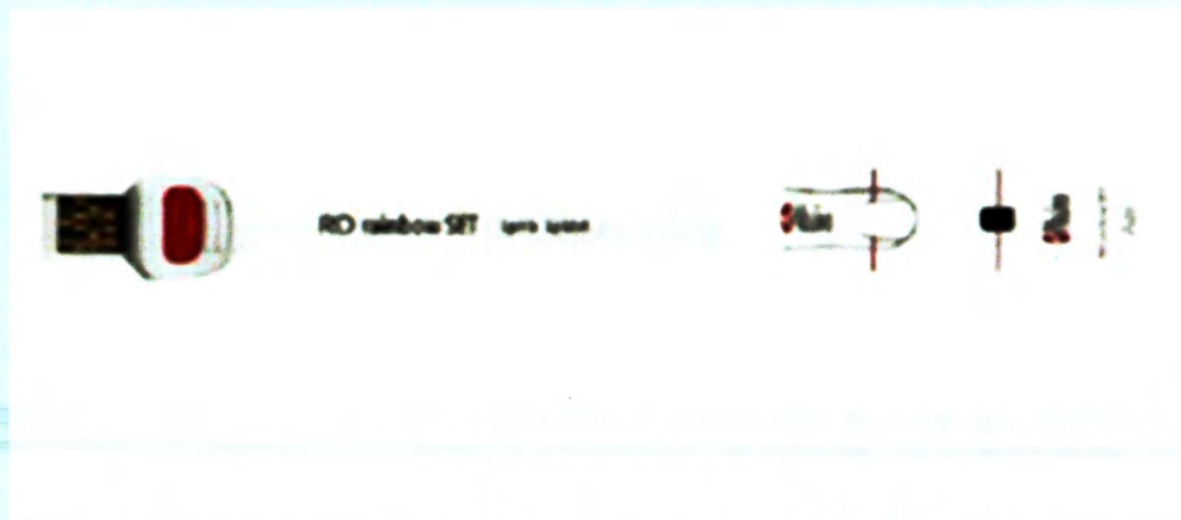

Одноразовый SpO₂ датчик для взрослых и новорожденных, модель RD rainbow Neo

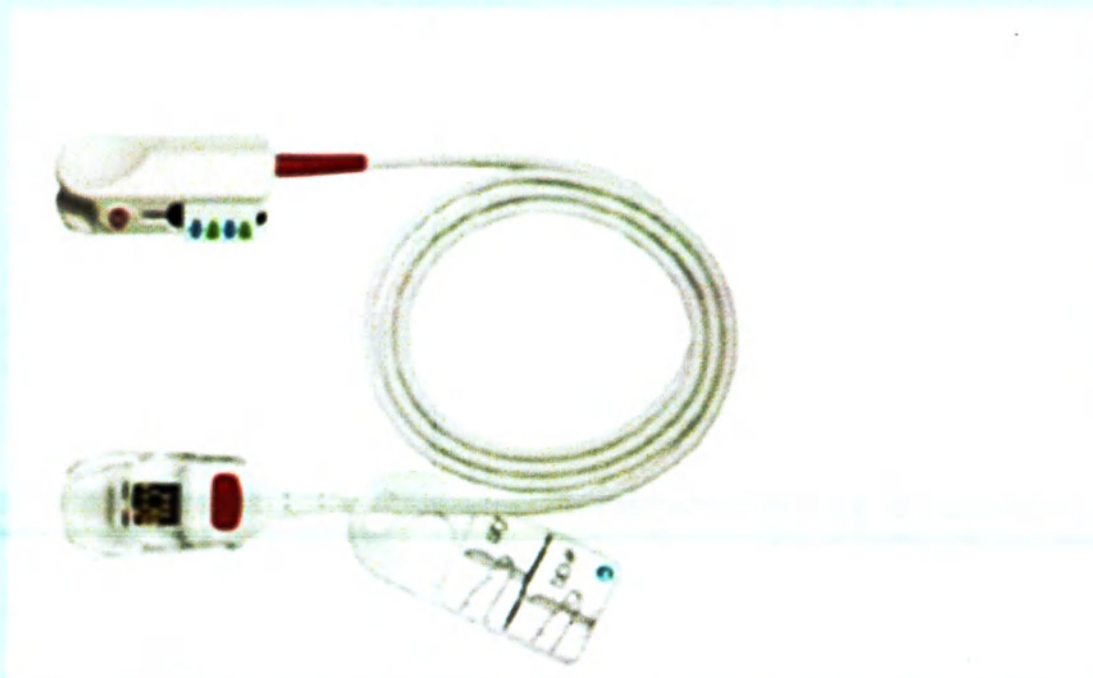


Интегрируемый модуль NMT

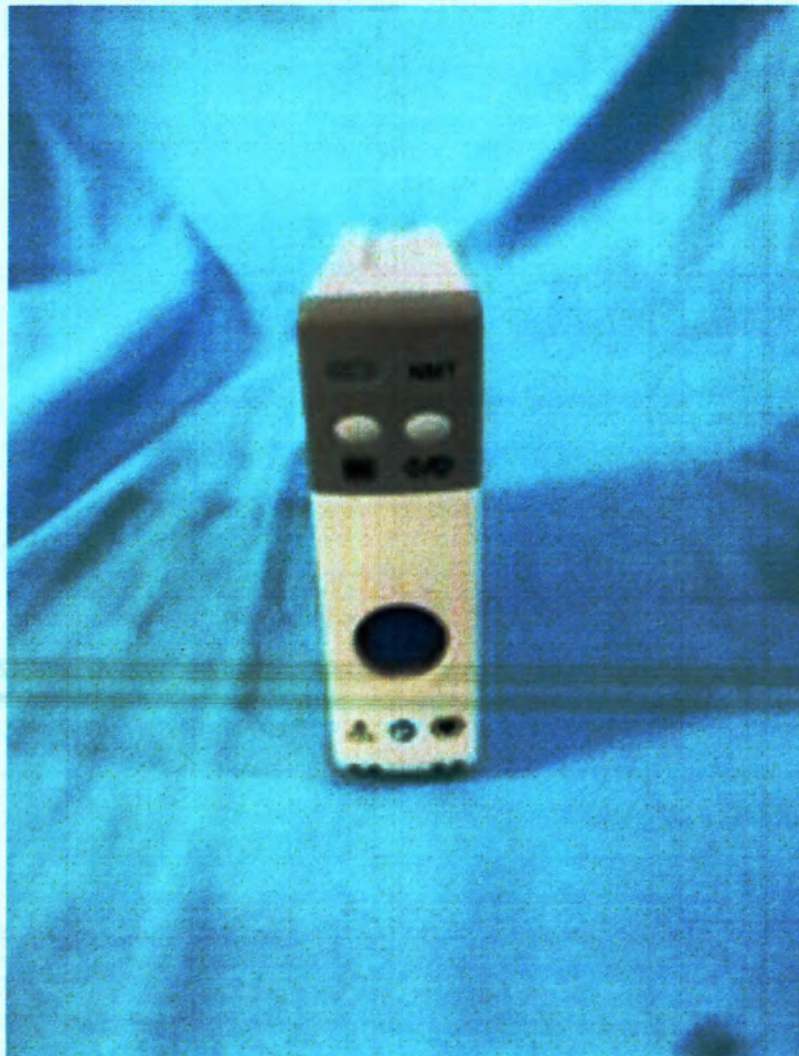

Датчик NMT



Электрод NMT

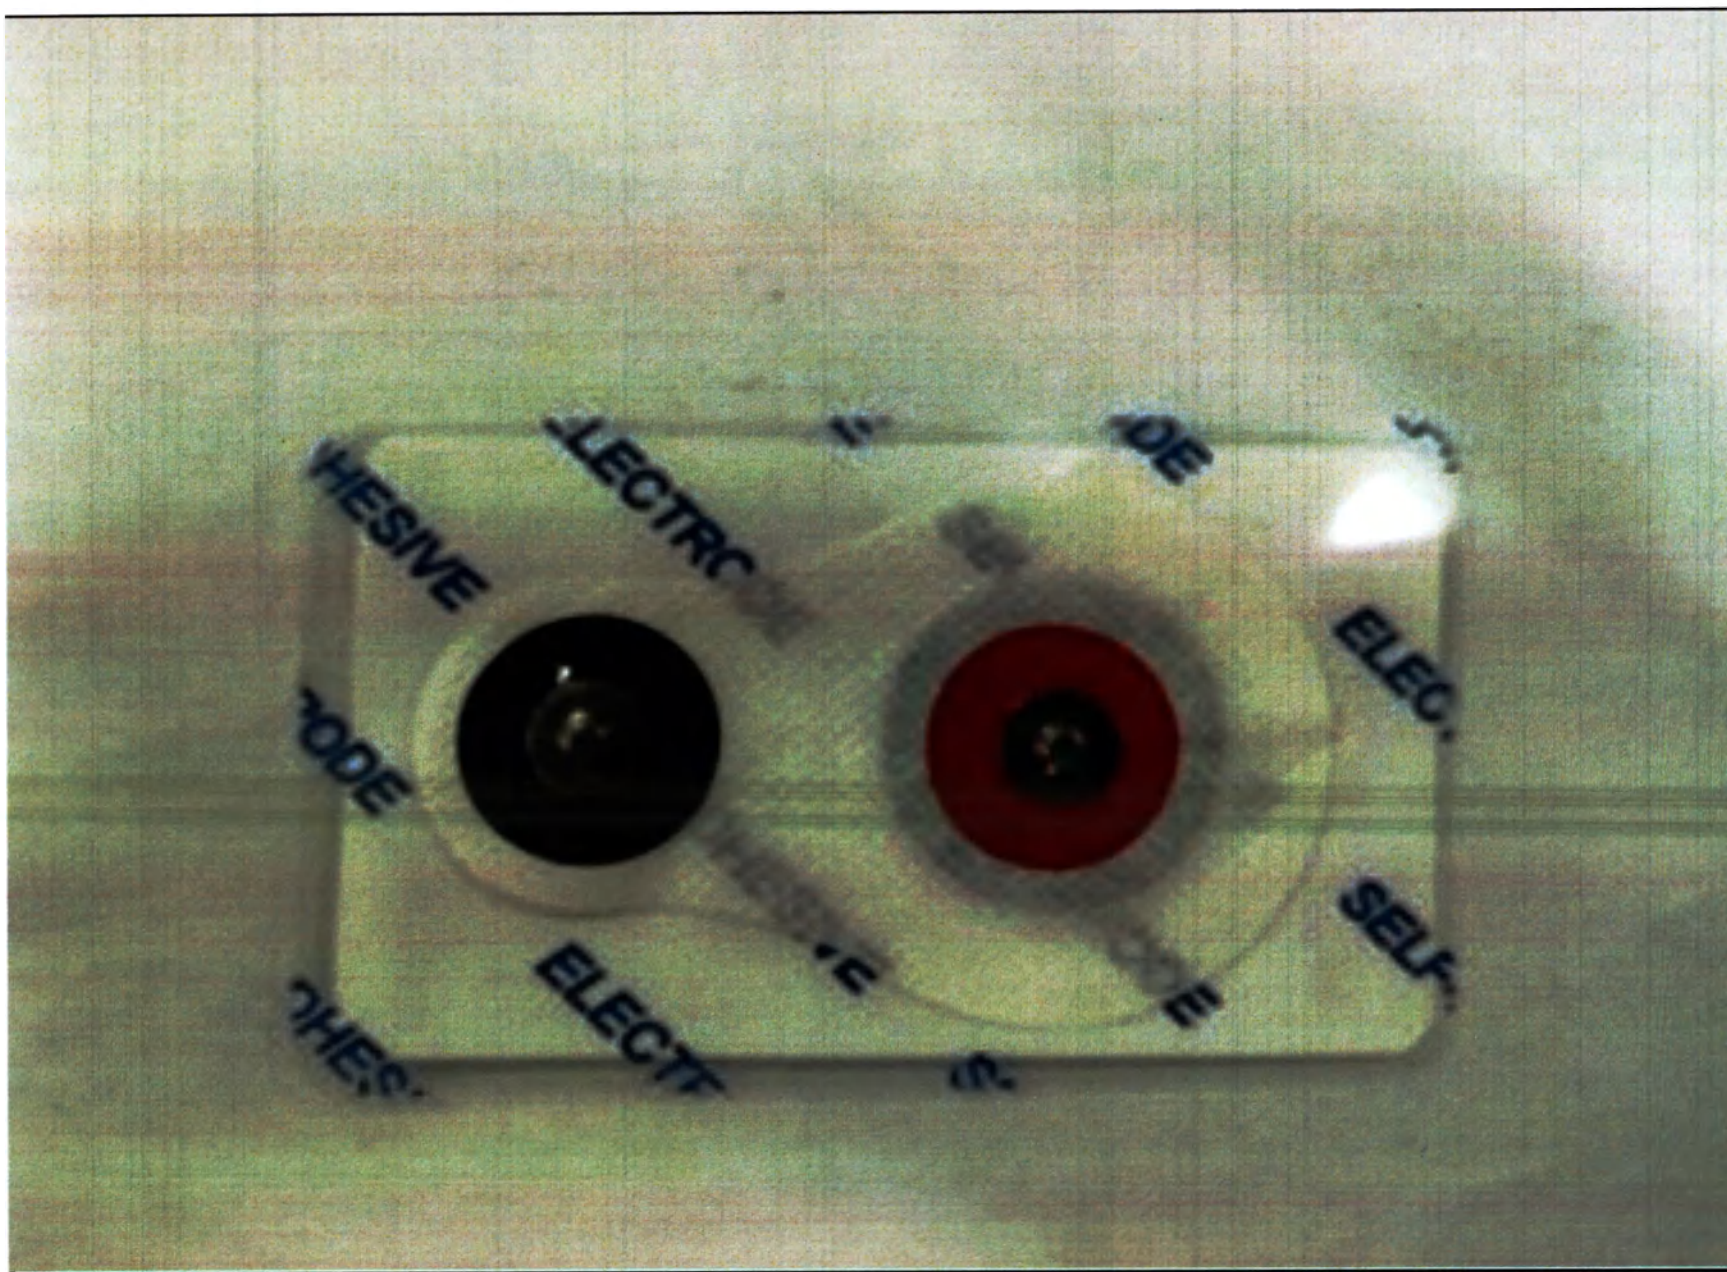


Встраиваемая аккумуляторная батарея 2500мАч




Встраиваемая аккумуляторная батарея 5000мАч



Штатив с фиксированной высотой GCX

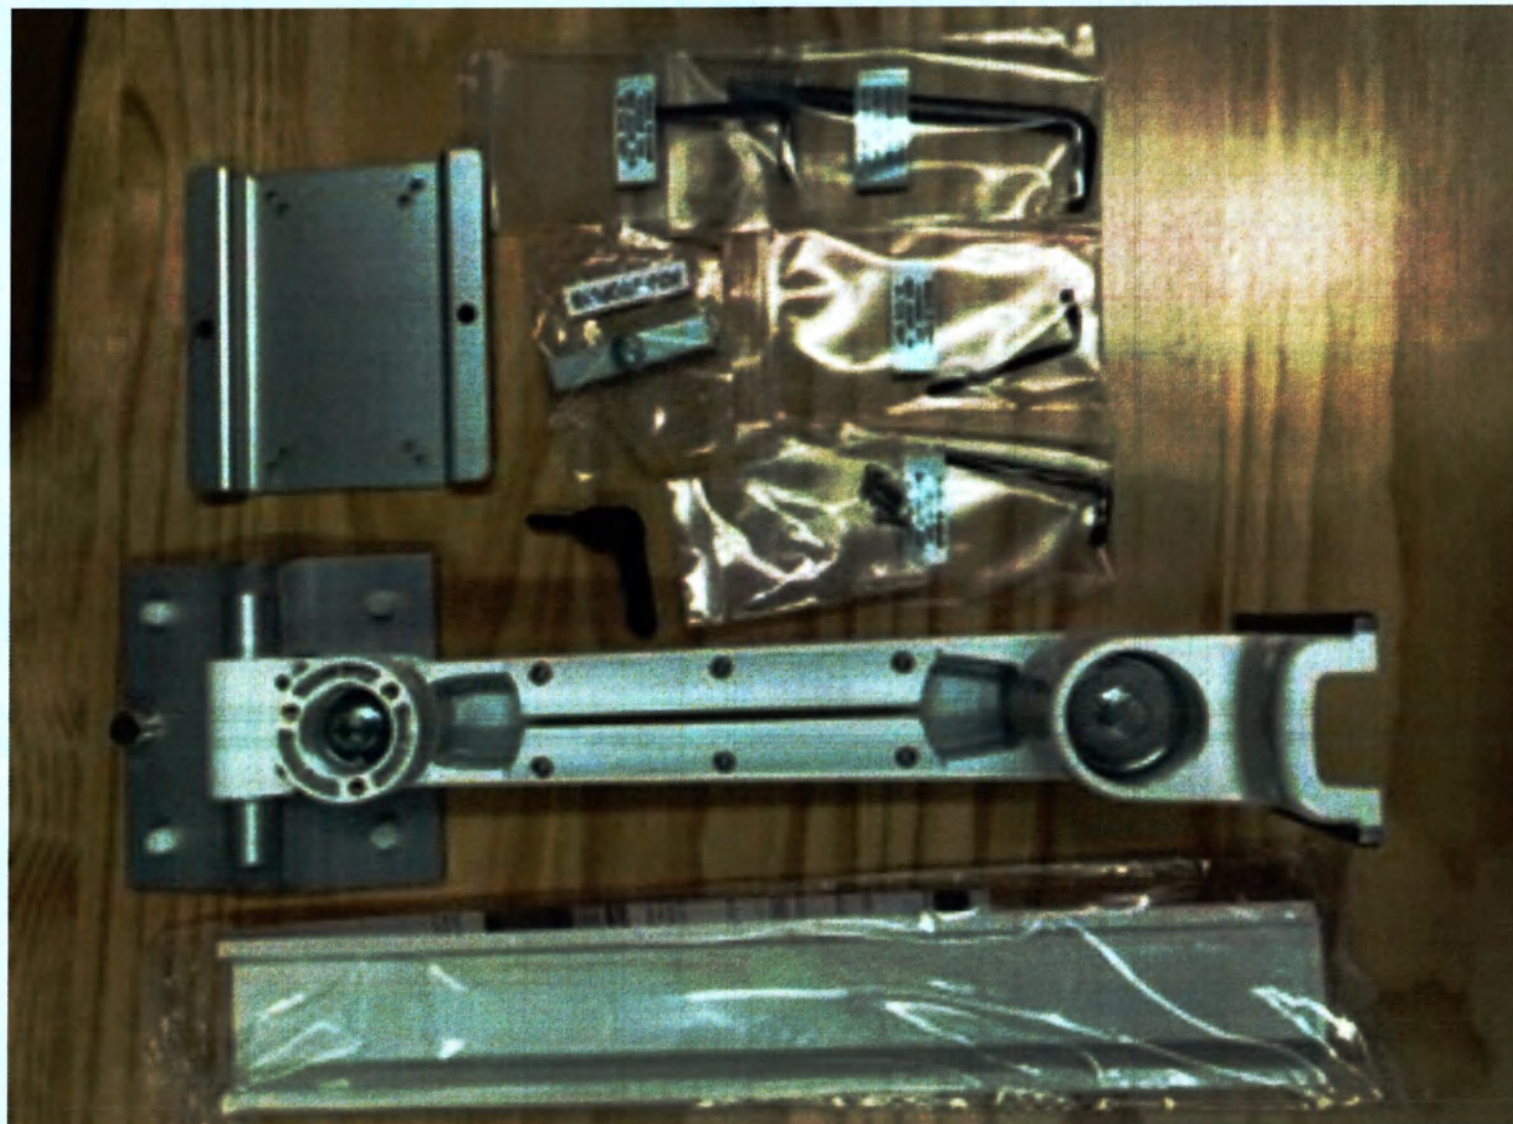


Направляющий штатива

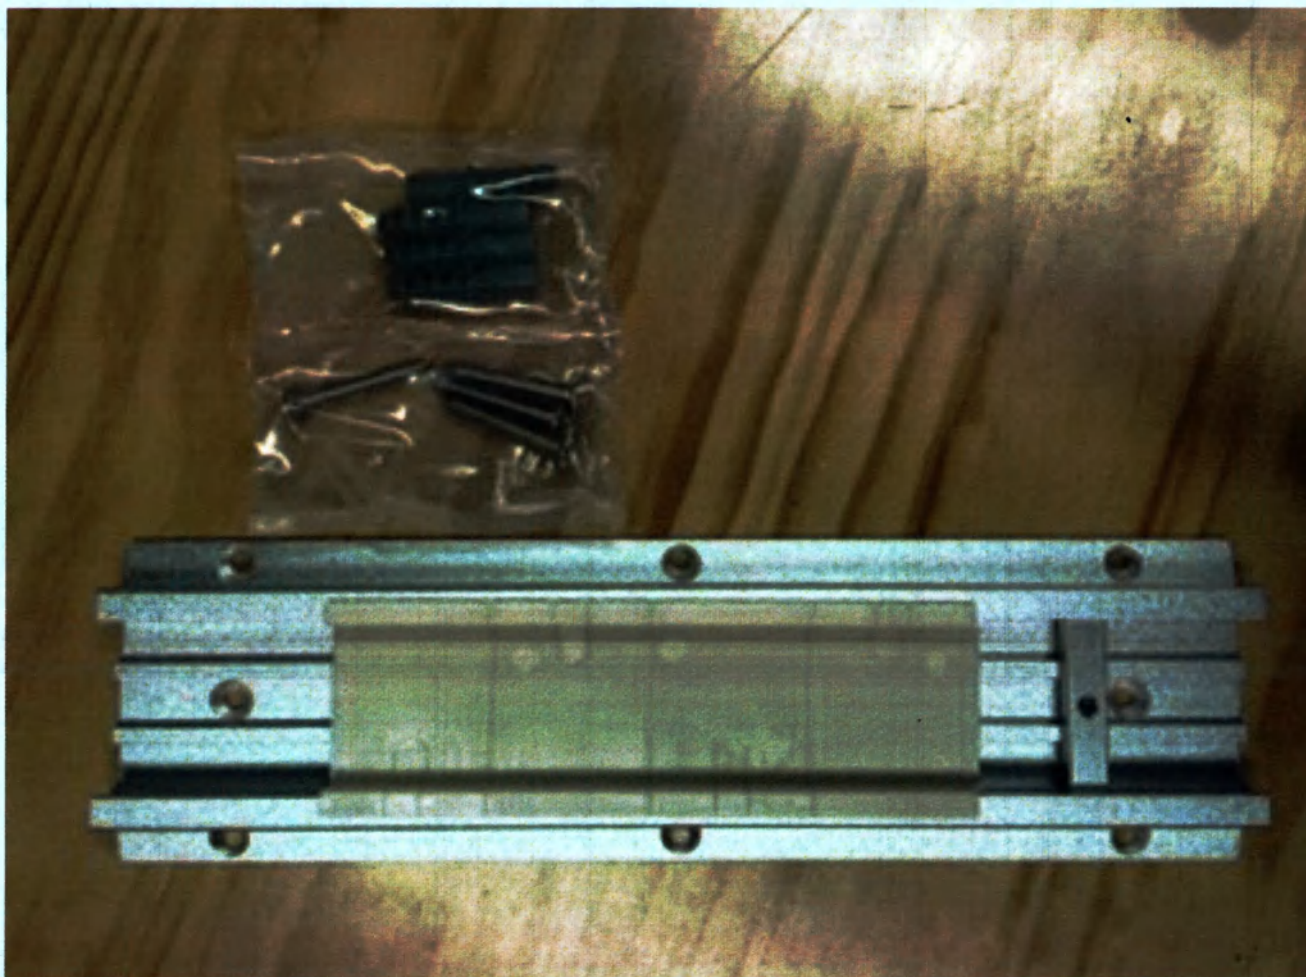

Тележка



Бумага для печати

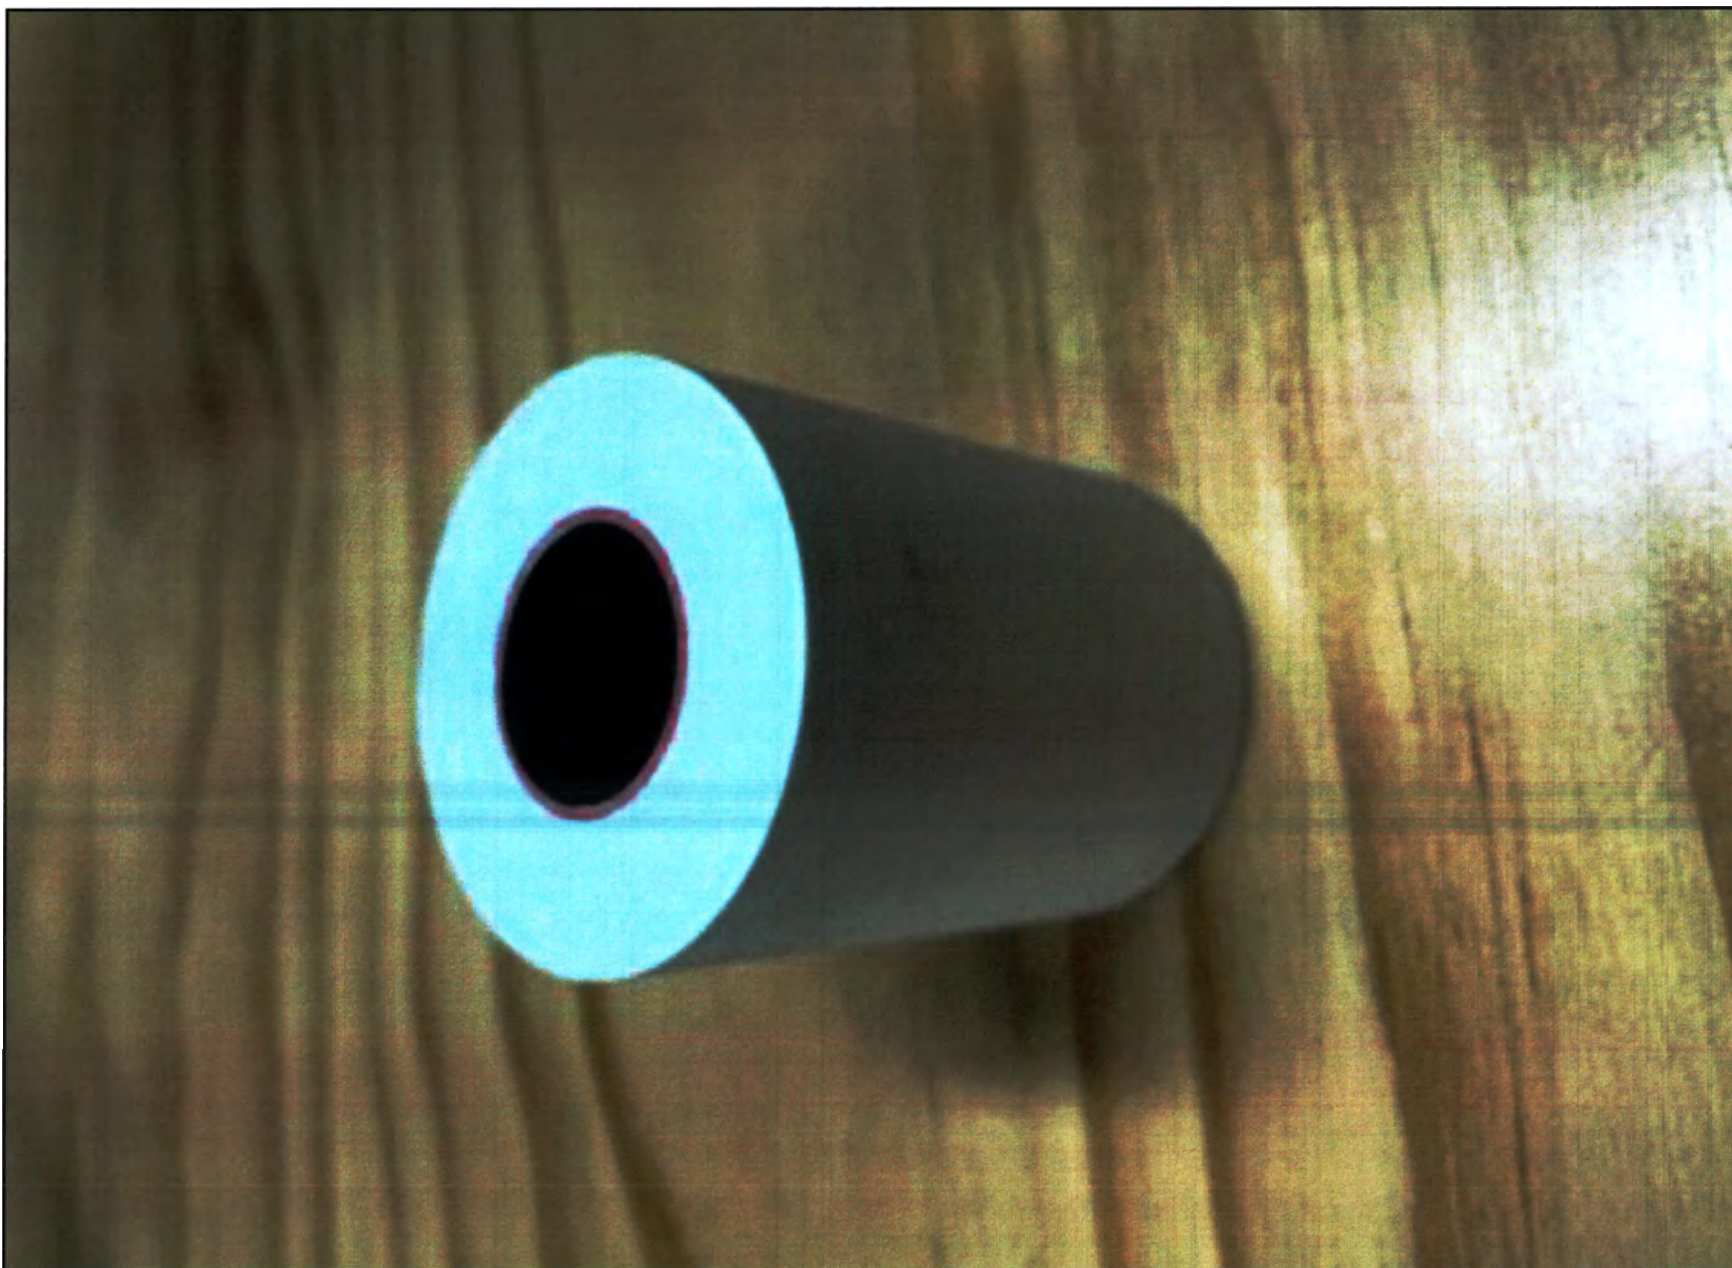



ВСЕГО ПРИБЛИЖИТЕЛЬНО
И СКРЕПЛЕНО
141 ЛИСТАМИ