

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор
ООО «Нейропроджект»

Д.М. Чебурашкин



МАКЕТЫ РУССКОЯЗЫЧНЫХ МАРКИРОВОК НА МЕДИЦИНСКОЕ
ИЗДЕЛИЕ:

Клапаны ВМІ для шунтирования спинномозговой жидкости, с
принадлежностями

*Производства Веллонг Инструментс Ко., Лтд. (Wellong Instruments Co., Ltd.), Тайвань,
Китайская Республика*

Клапан ВМІ контурный, низкого давления

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 02812L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан ВМІ контурный, низкого давления – 1 шт.

2. Фиксатор -1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Клапан ВМІ контурный, среднего давления

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 02812M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан ВМІ контурный, среднего давления – 1 шт.

2. Фиксатор -1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Клапан ВМІ контурный, высокого давления

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 02812Н

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан ВМІ контурный, высокого давления – 1 шт.

2. Фиксатор -1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO

**Клапан ВМІ контурный, низкого давления,
с антисифонным устройством давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04127L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан ВМІ контурный, низкого давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Фиксатор -1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Клапан ВМІ контурный, среднего давления,
с антисифонным устройством давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04127М

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан ВМІ контурный, среднего давления, с антисифонным устройством – 1 шт.
2. Фиксатор -1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Клапан ВМІ контурный, высокого давления,
с антисифонным устройством**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04127Н

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан ВМІ контурный, высокого давления, с антисифонным устройством – 1 шт.
2. Фиксатор -1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Микроклапан ВМІ контурный, низкого давления

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04120L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан ВМІ контурный, низкого давления – 1 шт.

2. Фиксатор -1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO

**Микроклапан ВМІ контурный, среднего давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04120M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан ВМІ контурный, среднего давления – 1 шт.

2. Фиксатор -1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Микроклапан ВМІ контурный, высокого давления

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04120H

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан ВМІ контурный, высокого давления – 1 шт.

2. Фиксатор -1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструменте Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Микроклапан ВМІ контурный, низкого давления,
с антисифонным устройством**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04125L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан ВМІ контурный, низкого давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Фиксатор -1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструменте Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Микроклапан ВМІ контурный, среднего давления,
с антисифонным устройством**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04125M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан ВМІ контурный, среднего давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Фиксатор -1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



**Микроклапан ВМІ контурный, высокого давления,
с антисифонным устройством**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04125H

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан ВМІ контурный, высокого давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Фиксатор -1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



Клапан BMI Burr Hole 14 мм, низкого давления

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 02514L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 14 мм, низкого давления – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173

**Клапан BMI Burr Hole 14 мм, среднего давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 02514M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 14 мм, среднего давления – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.


Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173

**Клапан BMI Burr Hole 14 мм, высокого давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 02514H

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 14 мм, высокого давления – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



Клапан BMI Burr Hole 16 мм, низкого давления

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04126L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 16 мм, низкого давления – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173**Клапан BMI Burr Hole 16 мм, среднего давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04126M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 16 мм, среднего давления – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173**Клапан BMI Burr Hole 16 мм, высокого давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04126H

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 16 мм, высокого давления – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173

Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, низкого давления

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 02512L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, низкого давления – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO

**Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, среднего давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 02512M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, среднего давления – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO

**Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, высокого давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 02512H

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, высокого давления – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Клапан BMI Burr Hole 14 мм, низкого давления,
с антисифонным устройством**

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до:

Артикул: 04123L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 14 мм, низкого давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Клапан BMI Burr Hole 14 мм, среднего давления,
с антисифонным устройством**

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до:

Артикул: 04123M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 14 мм, среднего давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Клапан BMI Burr Hole 14 мм, высокого давления,
с антисифонным устройством**

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до:

Артикул: 04123H

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 14 мм, высокого давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Клапан BMI Burr Hole 16 мм, низкого давления,
с антисифонным устройством**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04122L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 16 мм, низкого давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



**Клапан BMI Burr Hole 16 мм, среднего давления,
с антисифонным устройством**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04122M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 16 мм, среднего давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



**Клапан BMI Burr Hole 16 мм, высокого давления,
с антисифонным устройством**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04122H

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Burr Hole 16 мм, высокого давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, низкого давления, с антисифонным устройством

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04121L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, низкого давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, среднего давления, с антисифонным устройством

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04121M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, среднего давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, высокого давления,
с антисифонным устройством**

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до: _____

Артикул: 04121H

Код партии: _____

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, высокого давления, с антисифонным устройством – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Клапан BMI малый, интегрированный с
перитонеальным катетером на низкое давление**

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до: _____

Артикул: 03103L

Код партии: _____

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI малый, интегрированный с перитонеальным катетером на низкое давление – 1 шт

2. Катетер вентрикулярный – 1 шт

3. Фиксатор – 1 шт

4. Коннектор прямой – 1 шт

5. Стиллет – 1 шт

6. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Клапан ВМІ малый, интегрированный с перитонеальным катетером на среднее давление

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 03103М

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан ВМІ малый, интегрированный с перитонеальным катетером на среднее давление – 1 шт
2. Катетер вентрикулярный – 1 шт
3. Фиксатор – 1 шт
4. Коннектор прямой – 1 шт
5. Стиллет – 1 шт
6. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструменте Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Клапан ВМІ малый, интегрированный с перитонеальным катетером на высокое давление

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 03103Н

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан ВМІ малый, интегрированный с перитонеальным катетером на высокое давление – 1 шт
2. Катетер вентрикулярный – 1 шт
3. Фиксатор – 1 шт
4. Коннектор прямой – 1 шт
5. Стиллет – 1 шт
6. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструменте Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Катетер вентрикулярный

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 01101

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер вентрикулярный (1 шт); стилет (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO

**Катетер вентрикулярный, с коннектером Luer**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06115

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер вентрикулярный (1 шт); заглушка Luer Lock (1 шт); коннектер Luer (1 шт);

стиллет (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO

**Катетер вентрикулярный, антибактериальный**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 21101

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер вентрикулярный антибактериальный (1 шт); стилет (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Катетер перитонеальный низкого давления

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 03105L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер перитонеальный низкого давления (1 шт); коннектор Luer (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO

**Катетер перитонеальный среднего давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 03105M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер перитонеальный среднего давления (1 шт); коннектор Luer (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO

**Катетер перитонеальный высокого давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 03105H

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер перитонеальный высокого давления (1 шт); коннектор Luer (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Катетер перитонеальный антибактериальный,
низкого давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 23105L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Стерильно. Апирогенно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Катетер перитонеальный антибактериальный,
среднего давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 23105M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Стерильно. Апирогенно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Катетер перитонеальный антибактериальный,
высокого давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 23105H

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

Стерильно. Апирогенно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Катетер атриальный

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 03107

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер атриальный (1 шт); коннектор (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO

**Набор BMI Uni-Shunt вентрикуло-перитонеальный, низкого давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 05106L

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

вентрикуло-перитонеальный катетер низкого давления (1 шт); фиксатор (1 шт);

инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO

**Набор BMI Uni-Shunt вентрикуло-перитонеальный, среднего давления**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 05106M

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

вентрикуло-перитонеальный катетер среднего давления (1 шт); фиксатор (1 шт);

инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Набор BMI Uni-Shunt вентрикуло-перитонеальный, высокого давления

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 05106Н

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

вентрикуло-перитонеальный катетер высокого давления (1 шт); фиксатор (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Антисифонное устройство

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04118

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Коннектор прямой

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 05103

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Стерильно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Коннектор угловой

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до: _____

Артикул: 05104

Код партии: _____

Кол-во: 1 шт.

Стерильно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173**Коннектор трехходовой**

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до: _____

Артикул: 05105

Код партии: _____

Кол-во: 1 шт.

Стерильно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173**Перитонеальный троакар**

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до: _____

Артикул: R-4215

Код партии: _____

Кол-во: 3 шт.

Стерильно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173

Проводник для подкожного тоннелирования,

38 см

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: R-48403

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Стерильно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Проводник для подкожного тоннелирования,

60 см

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: R-48405

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Стерильно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Проводник для подкожного тоннелирования
перитонеального катетера, 38 см**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: US-62

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Стерильно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Проводник для подкожного тоннелирования
перитонеального катетера, 60 см**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: US-62

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Стерильно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Пример русскоязычной маркировки на вторичной упаковке, в случае если изделия
поставляются в составе с изделиями «при необходимости».**

**Клапан ВМІ контурный, низкого
давления, в составе**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 02812L+01101+23105L

Код партии: ____ + ____ + ____

Кол-во: 1 уп.

Состав упаковки:

1. Клапан ВМІ контурный, низкого давления – 1 шт.

2. Фиксатор - 1 шт.

3. Катетер вентрикулярный, в составе: катетер вентрикулярный (1 шт); стилет (1 шт) – 1 шт.

4. Катетер перитонеальный низкого давления, в составе: катетер перитонеальный низкого давления (1 шт); коннектор Luer (1 шт) – 1 шт.

5. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Клапан BMI Butt Hole 16 мм, среднего давления,
с антисифонным устройством, в составе**
РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до: _____

Артикул: 04122M+01010+03105M+21101+03107

Код партии: ____ + ____ + ____ + ____ + ____

Кол-во: 1 уп.

Состав упаковки:

1. Клапан BMI Butt Hole 16 мм, среднего давления, с антисифонным устройством – 1 шт.
2. Катетер вентрикулярный, в составе: катетер вентрикулярный (1 шт); стилет (1 шт) – 1 шт
3. Катетер перитонеальный, среднего давления, в составе: катетер перитонеальный среднего давления (1 шт); коннектор Luer (1 шт) – 1 шт
4. Катетер вентрикулярный, антибактериальный, в составе: катетер вентрикулярный антибактериальный (1 шт); стилет (1 шт) – 1 шт
5. Катетер атриальный, в составе: катетер атриальный (1 шт); коннектор (1 шт) – 1 шт
6. Инструкция по применению – 1 шт

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173




STERILE EO



Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

24 (двадцать четыре) лист а

Директор  (Чебурашкин Д.М.)



«УТВЕРЖДЕНО»

Директор
ООО «Нейропроджект»



Д.М. Чебурашкин

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Клапаны ВМІ для шунтирования спинномозговой жидкости, с
принадлежностями

*Производства Веллонг Инструментс Ко., Лтд. (Wellong Instruments Co., Ltd.), Тайвань,
Китайская Республика*

STERILE EO

BMI® Contoured Valve Small

This package contains one:

- 1ea. CSF Flow Control Valve Contoured Small
With Medium Pressure Control
Thick : **5mm**
Length:20mm

- 1ea. Catheter Fixation Tab

REF



LOT



04120M 2028-08 RSBS8810 2023-08

STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Laana Med. B.V.
Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands



Wellong Instruments Co., Ltd
5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

3023MC



(01)04713945660371(17)280101(10)XES4371

Вторичная упаковка: Микроклапан BMI контурный, среднего давления, в составе: Микроклапан BMI контурный, среднего давления – 1 шт; Фиксатор -1 шт (артикул 04120M)

STERILE EO

BMI® Contoured Valve Small

This package contains one:

- 1ea. CSF Flow Control Valve Contoured Small
With Medium Pressure Control
Thick : **5mm**
Length:20mm
- 1ea. Catheter Fixation Tab

REF



LOT



04120M 2028-07 RSCS8809 2023-07



STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REF


Luana Med. B.V.
Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands



Wellong Instruments Co., Ltd
5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan.

Made in Taiwan

Первичная упаковка: Микроклапан BMI контурный, среднего давления, в составе: Микроклапан BMI контурный, среднего давления – 1 шт; Фиксатор -1 шт (артикул 04120M)

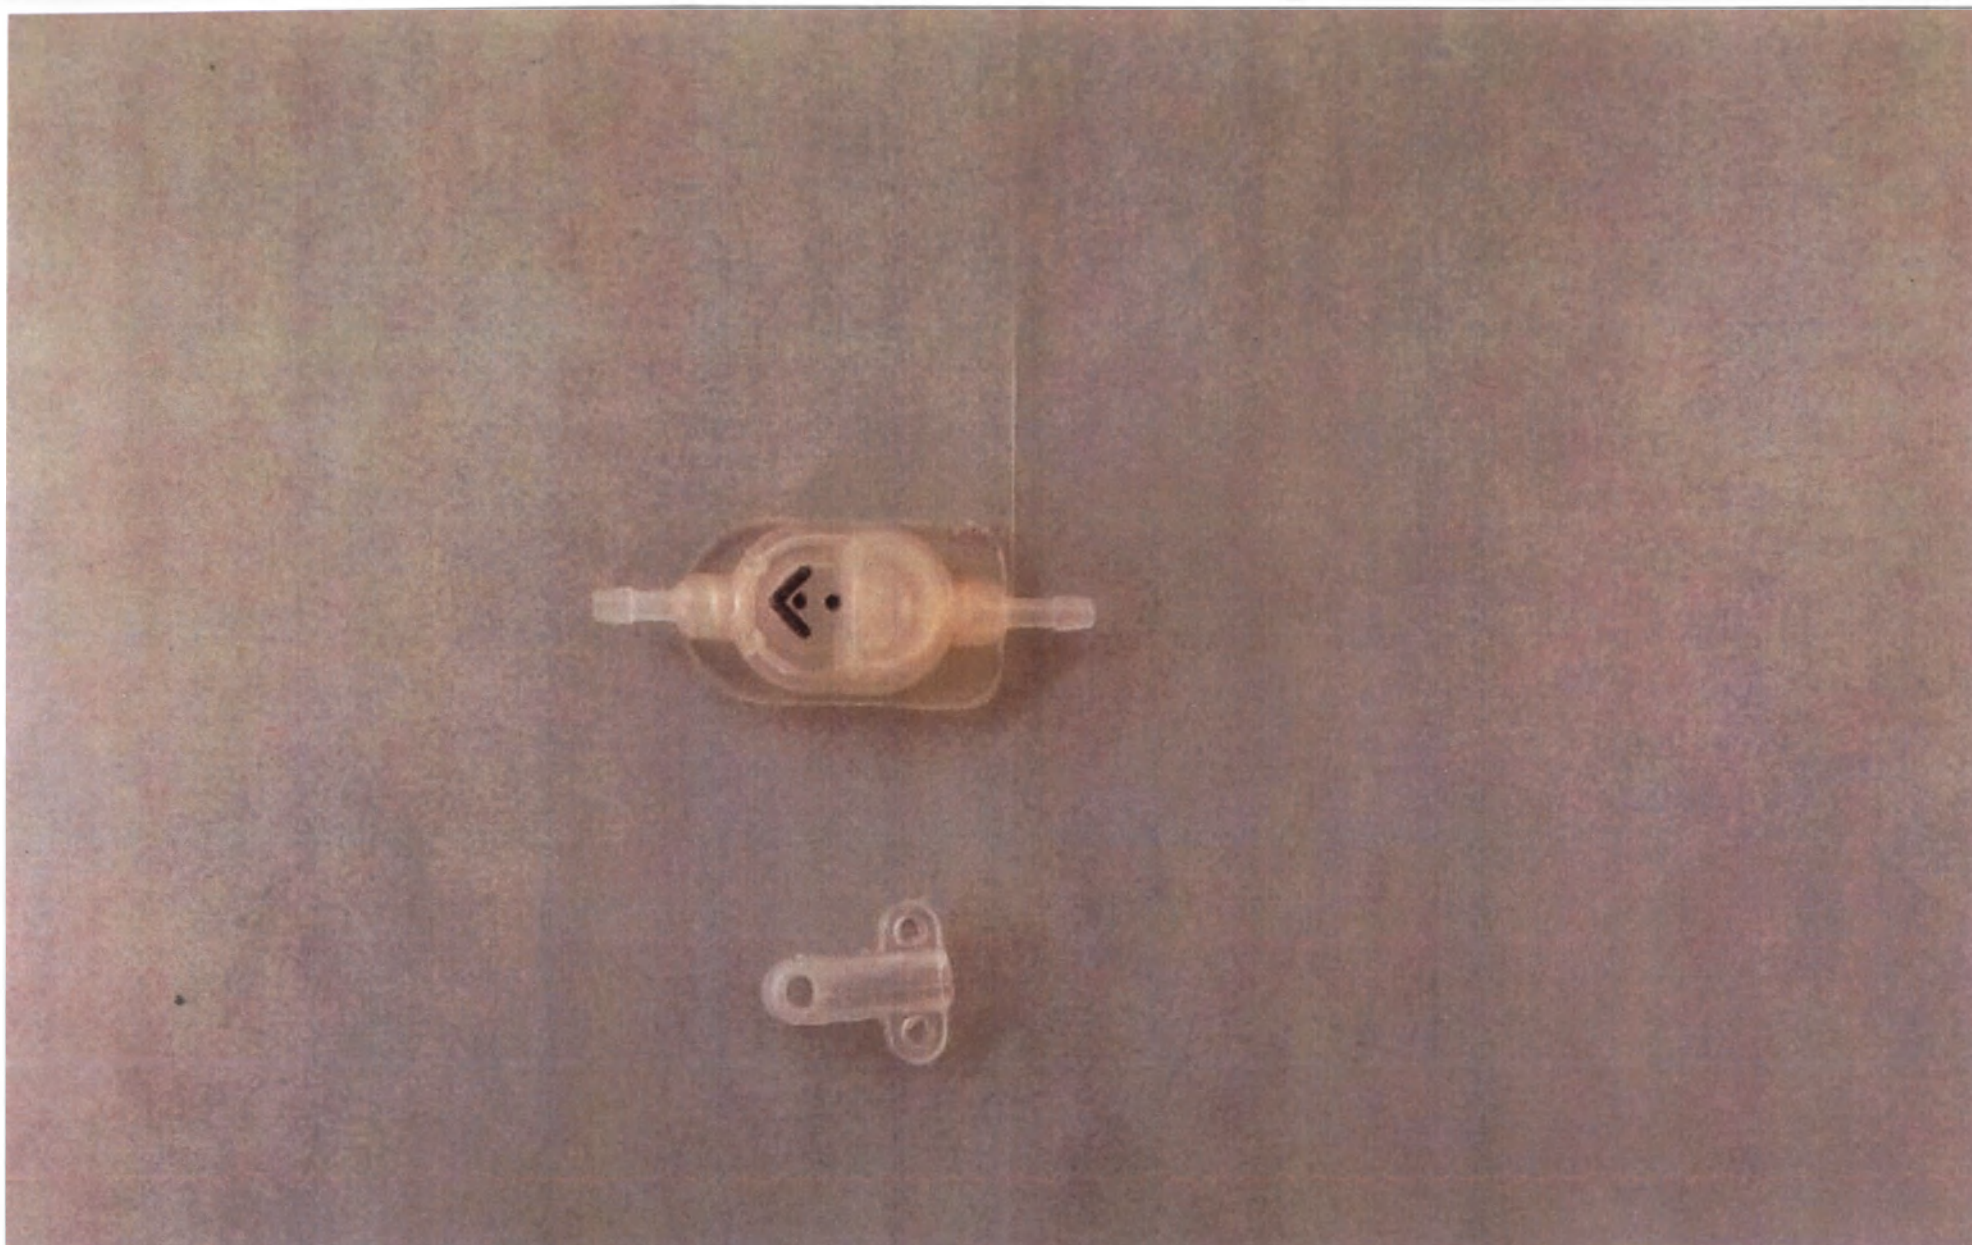

Микроклапан BMI контурный, среднего давления, в составе: Микроклапан BMI контурный, среднего давления – 1 шт; Фиксатор - 1 шт (артикул 04120М)

STERILE EO

BMI® Valve, Burr Hole

This package contains

1ea. CSF-Flow Valve,
Burr Hole Type, 12mm
Medium Pressure Control.

REF



LOT



02512M 2028-08 RSBS2019 2023-08



STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Luana Med. B.V.
Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands



Wellong Instruments Co., Ltd
5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202304E



(01)04713945660135(17)280101(10)XES4435

Вторичная упаковка Микроклапана BMI Burr Hole 12 мм, среднего давления (артикул 02512M)

STERILE EO

BMI® Valve, Burr Hole

This package contains

1ea. CSF-Flow Valve,
Burr Hole Type, 12mm
Medium Pressure Control.

REF



LOT



02512M 2028-08 RSBS2017 2023-08

STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.



CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Luana Med. B.V.
Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands




Wellong Instruments Co., Ltd
5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202308

Первичная упаковка Микроклапана BMI Burr Hole 12 мм, среднего давления (артикул 02512M)

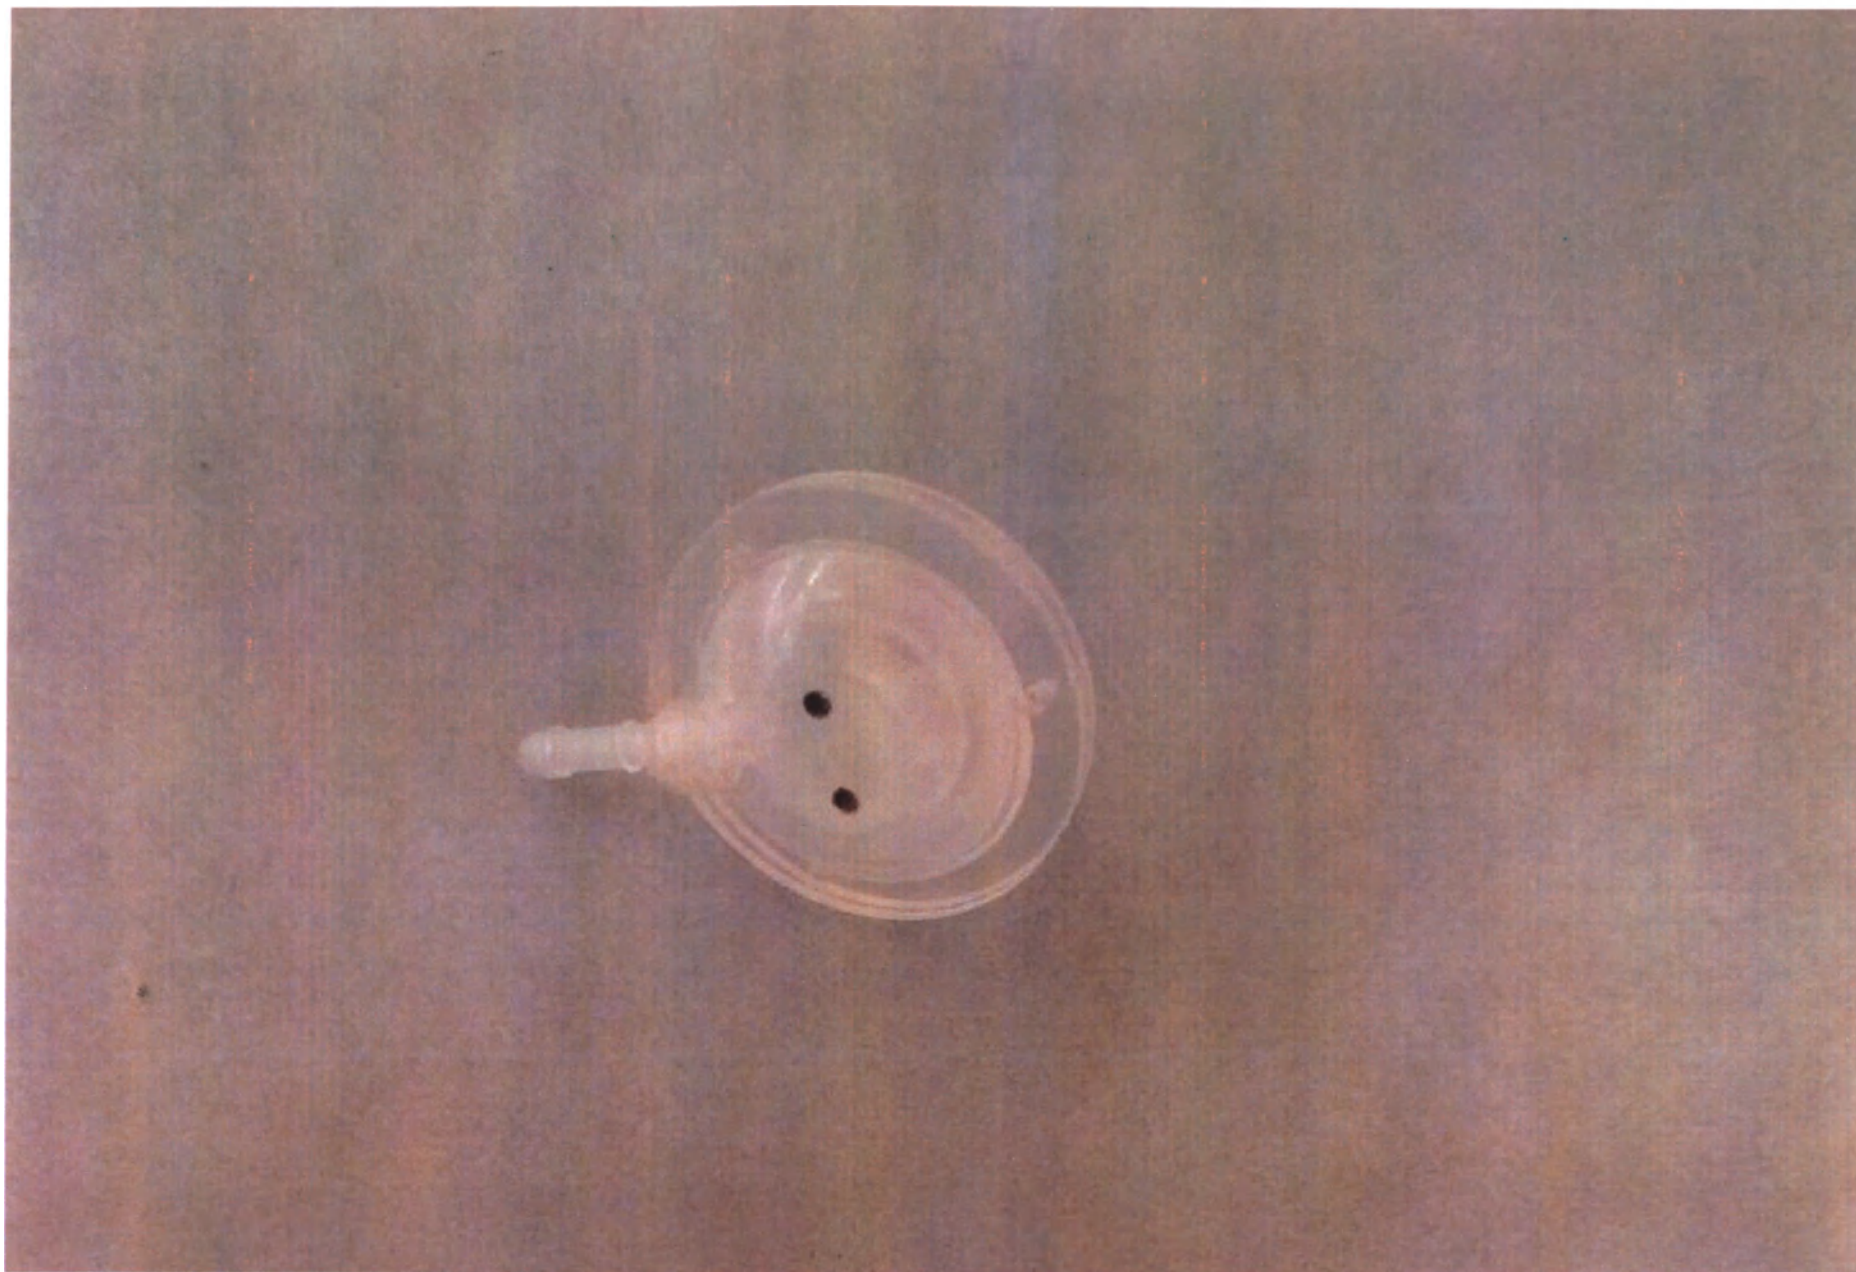

Микроклапан BMI Burr Hole 12 мм, среднего давления (артикул 02512М)

STERILE EO

BMI® Valve, Burr Hole

This package contains

1ea. CSF-Flow Valve,
Burr Hole Type, 14mm
Medium Pressure Control

REF



LOT



02514M 2028-08 RSBS7817 2023-08



STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



FC REP

Luana Med. B.V.
Weena Zuid, 139, Rotterdam, Netherlands



Wellong Instruments Co., Ltd
5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202304E



(01)04713945660173(17)280101(10)XES4173

Вторичная упаковка Клапана BMI Burr Hole 14 мм, среднего давления (артикул 02514M)

STERILE EO

BMI® Valve, Burr Hole

This package contains

1ea. CSF-Flow Valve,
Burr Hole Type, 14mm
Medium Pressure Control

REF



LOT



02514M 2028-08 RSBS7817 2023-08



STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Luana Med. B.V.
Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands




Wellong Instruments Co., Ltd.
5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.


Made in Taiwan

312204E

Первичная упаковка Клапана BMI Burr Hole 14 мм, среднего давления (артикул 02514M)

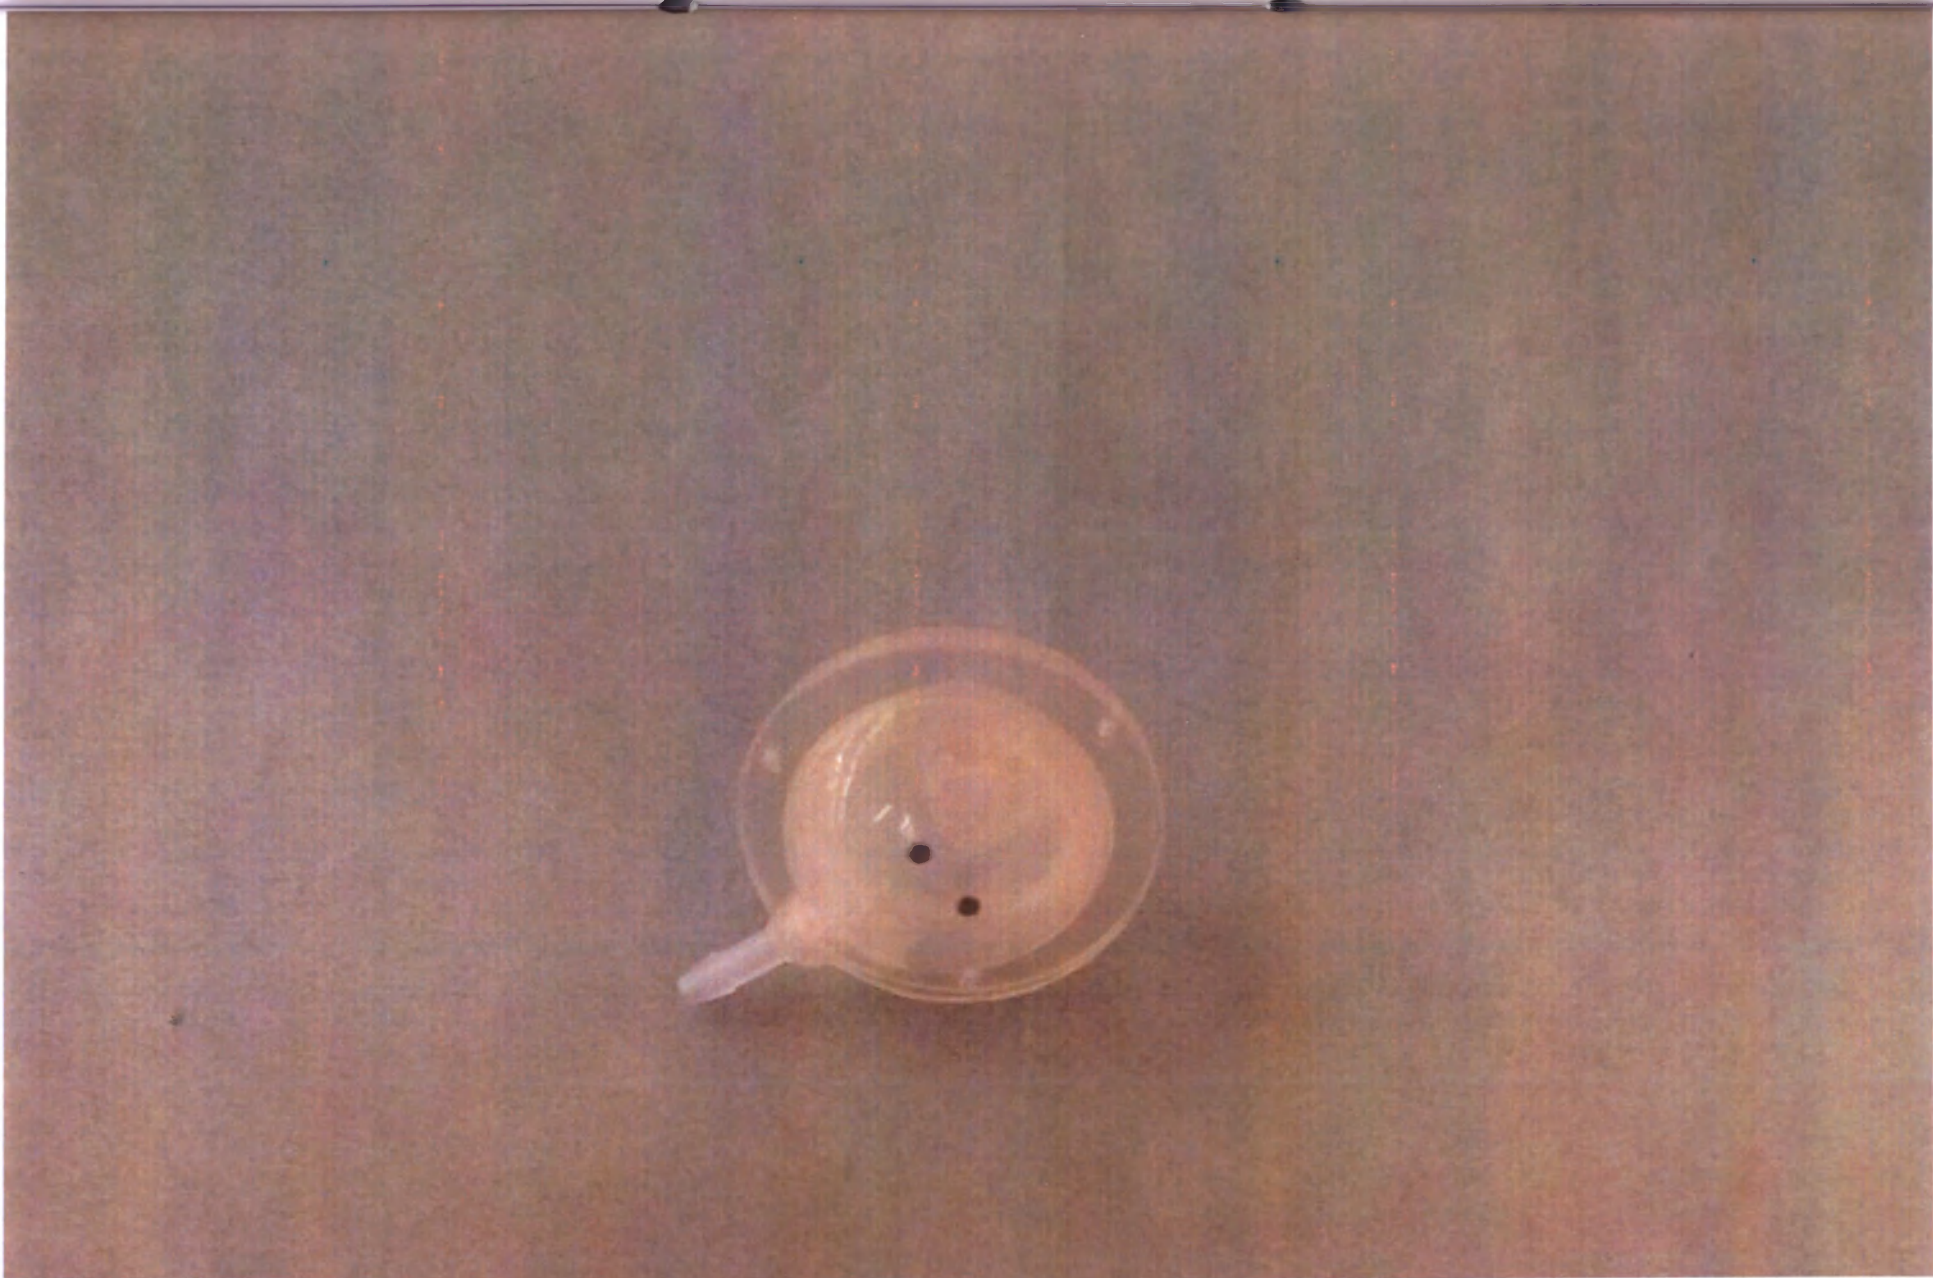

Клапан BMI Burr Hole 14 мм, среднего давления (артикул 02514М)

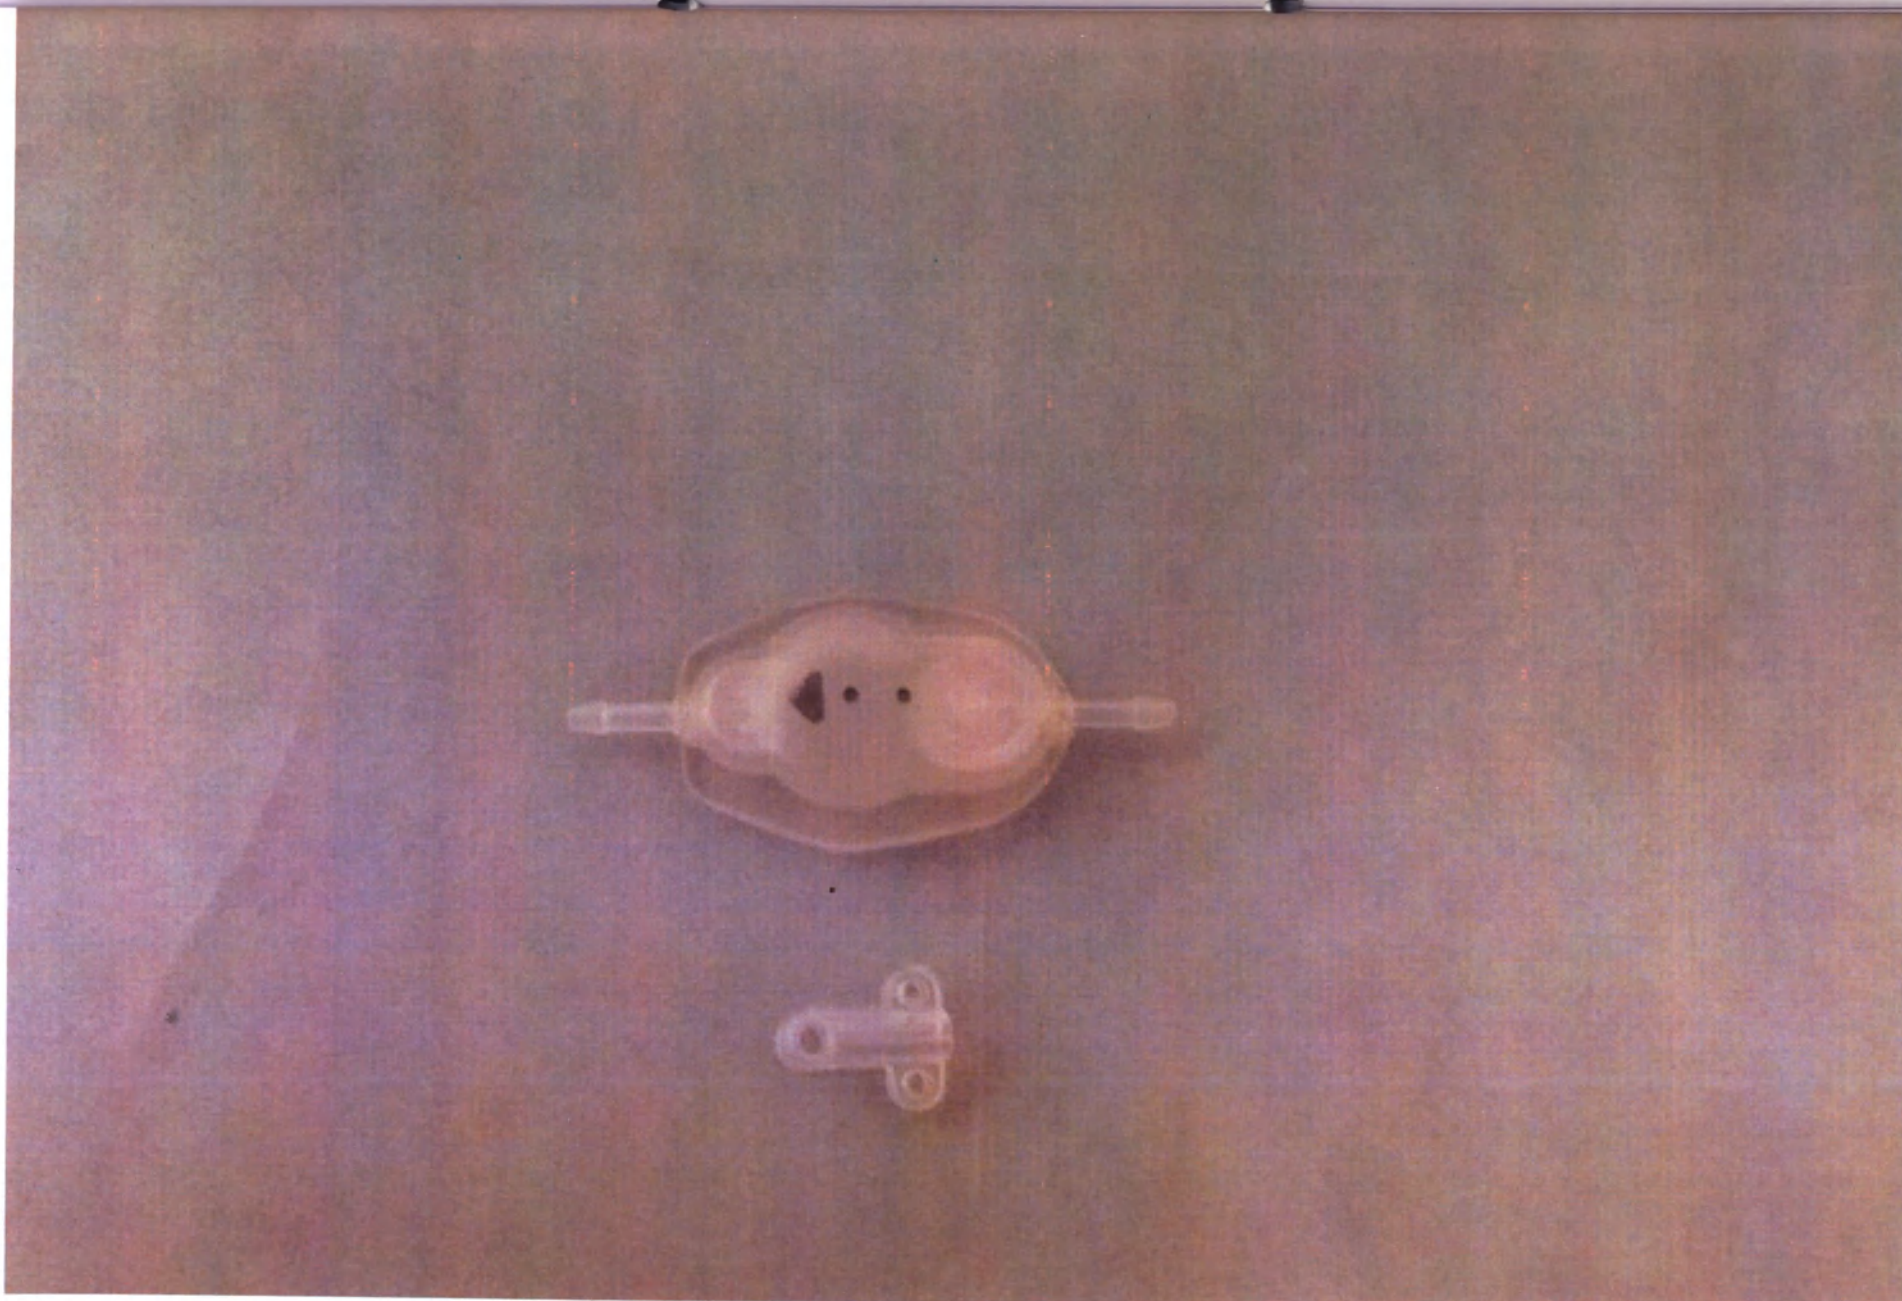

На фото: Клапан BMI контурный, среднего давления – 1 шт; Фиксатор - 1 шт. (артикул 02812М)

STERILE EO

BMI® Ventricular Catheter

This package contains:

1ea. Ventricular Catheter
Barium impregnated
I.D.:1.3mm O.D.:2.5mm
Length:20cm

1ea. Stylet

REF



LOT



01101 2028-08 RSBS1560 2023-08

STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.



CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EO REF

Lusena Med. B.V.
Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands



Wellong Instruments Co., Ltd
5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.


Made in Taiwan

282304E




(01)04713945660104(17)280101(10)XES4404

Вторичная упаковка Катетера вентрикулярного, в составе: катетер вентрикулярный (1 шт); стилет (1 шт)
(артикул 01101)

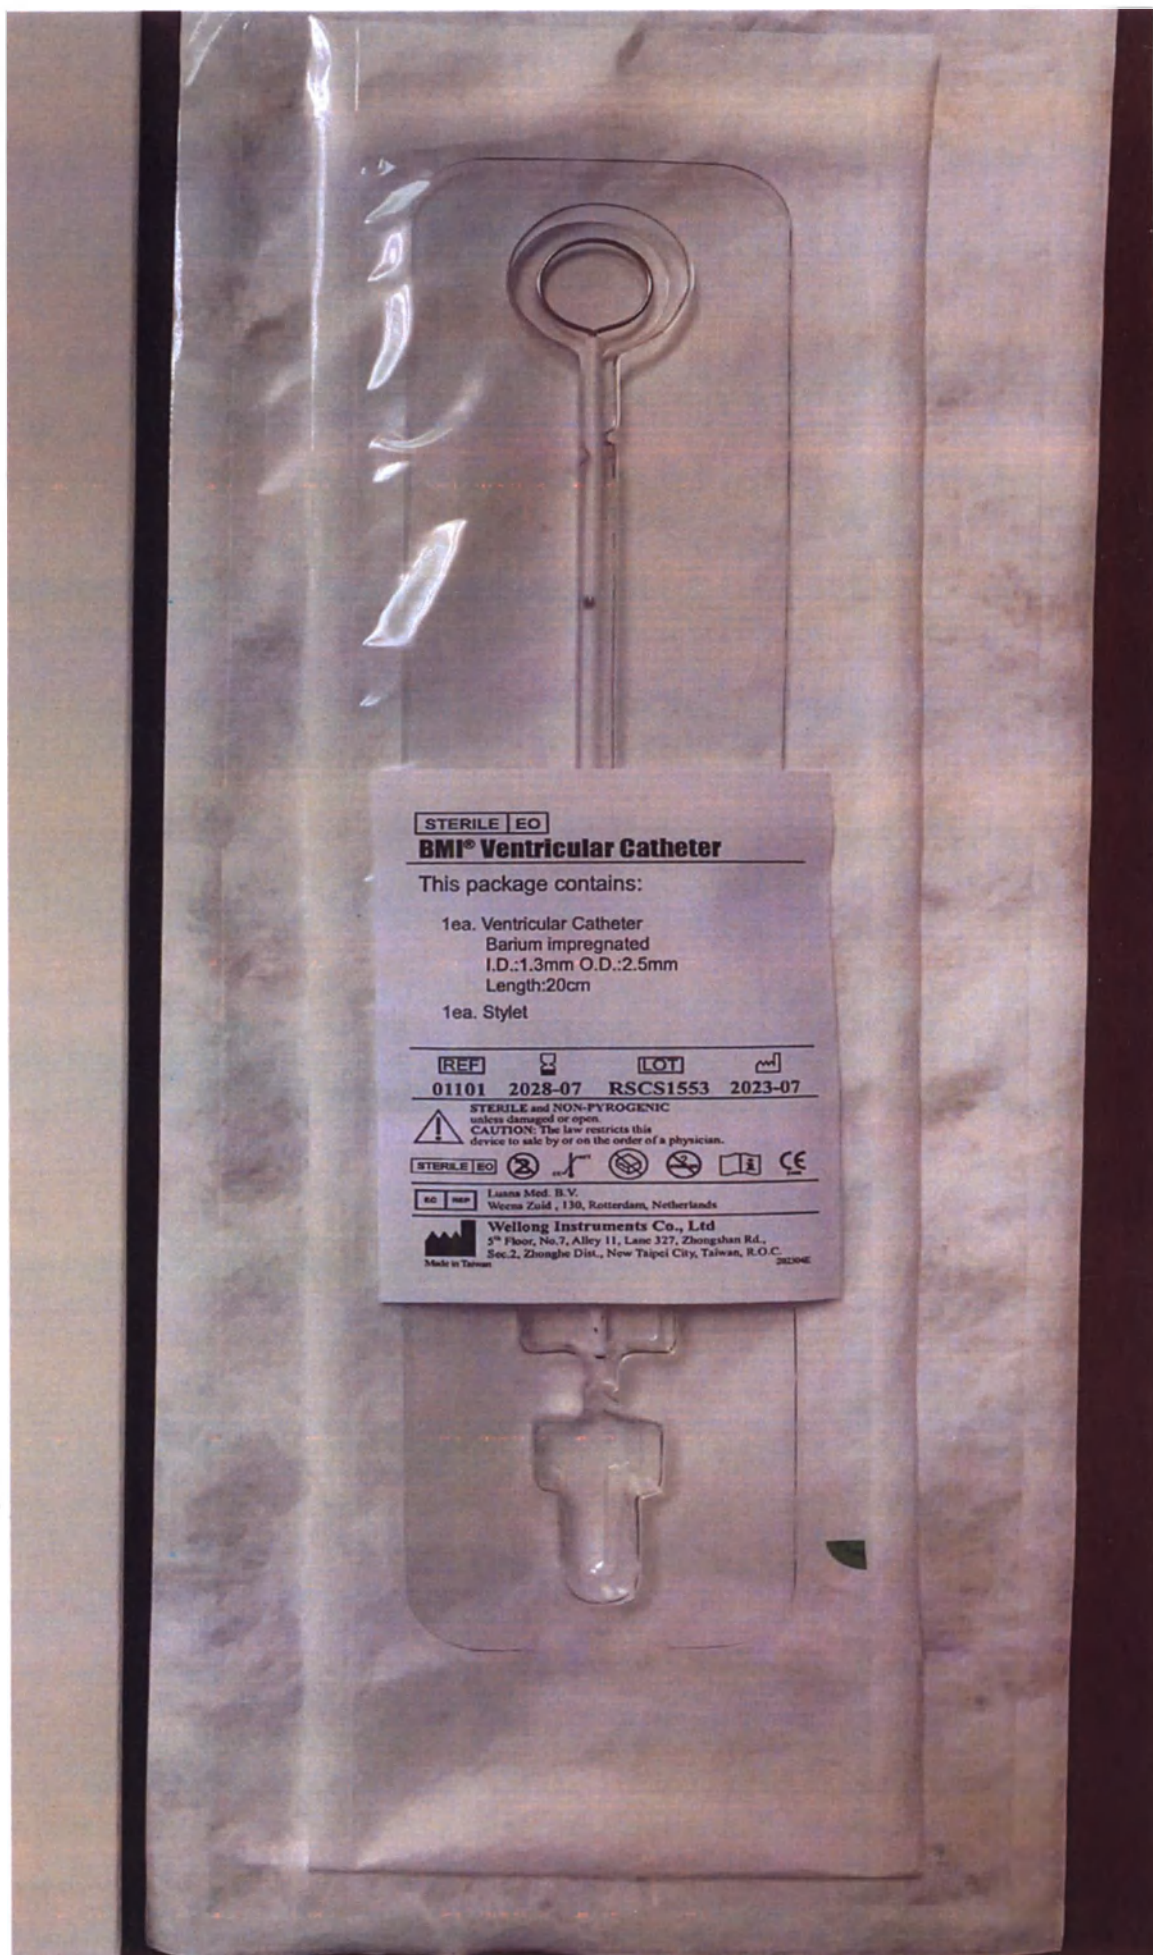

Первичная упаковка Катетера вентрикулярного, в составе: катетер вентрикулярный (1 шт); стилет (1 шт)
 артикул 01101)

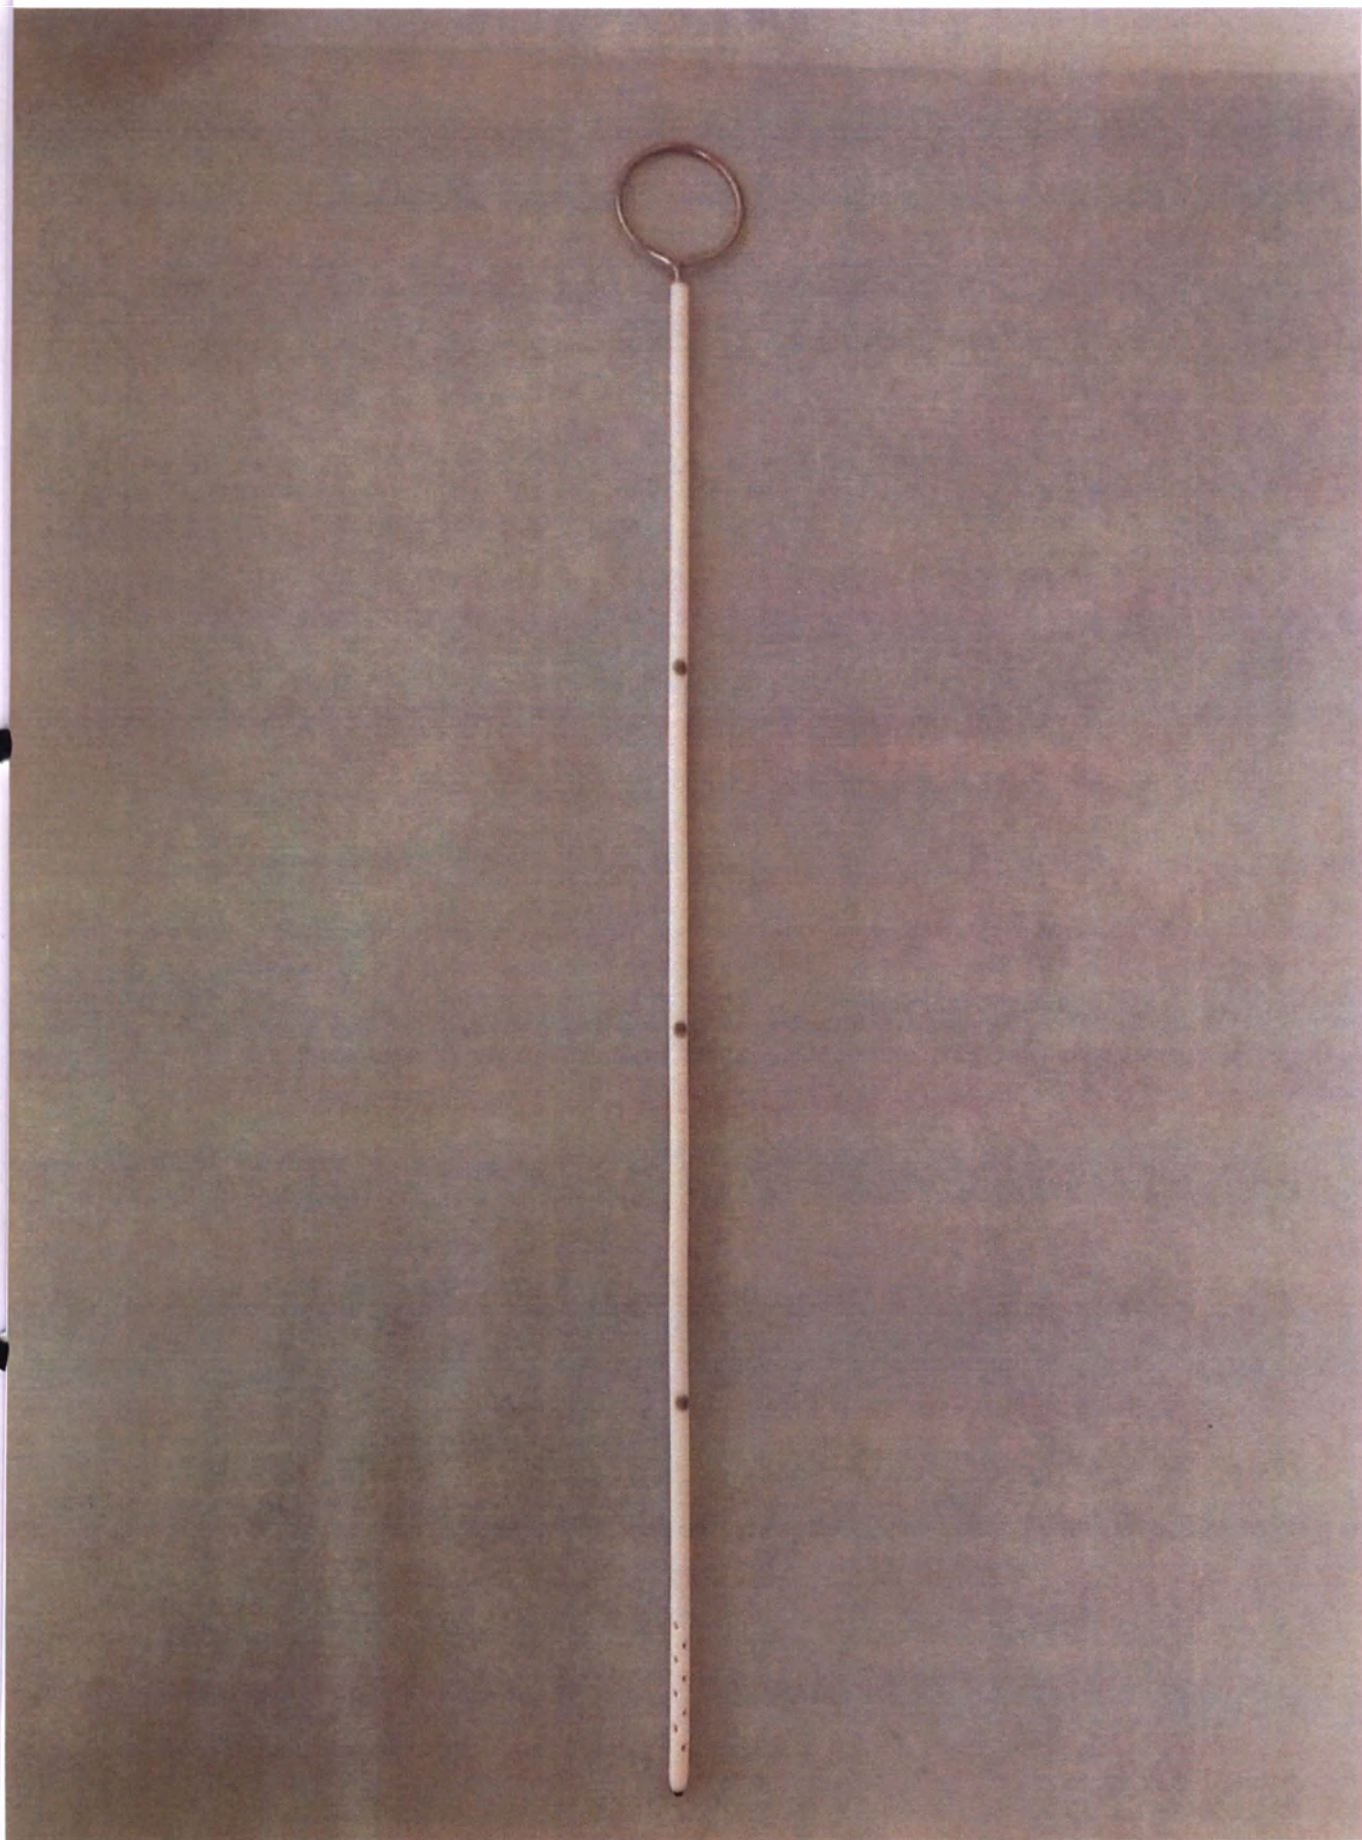

Катетер вентрикулярный, в составе: катетер вентрикулярный (1 шт); стилет (1 шт) (артикул 01101)

STERILE EO

BMI® Peritoneal Catheter

Package Contents (nominal dimensions):

- 1ea. Peritoneal Catheter,
Barium Impregnated,
I.D.:1.3mm O.D.:2.5mm
Length:100cm
Medium Pressure
- 1ea. Female Luer Adapter

REF LOT
03105M 2028-08 RSBS3359 2023-08

STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO

Luana Med. B.V.
Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands

Wellong Instruments Co., Ltd
5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.


Made in Taiwan

20230412




(01)04713945660258(17)280101(10)XES4258


Вторичная упаковка: Катетер перитонеальный, среднего давления, в составе: катетер перитонеальный среднего давления (1 шт); коннектор Luer (1 шт) (артикул 03105M)

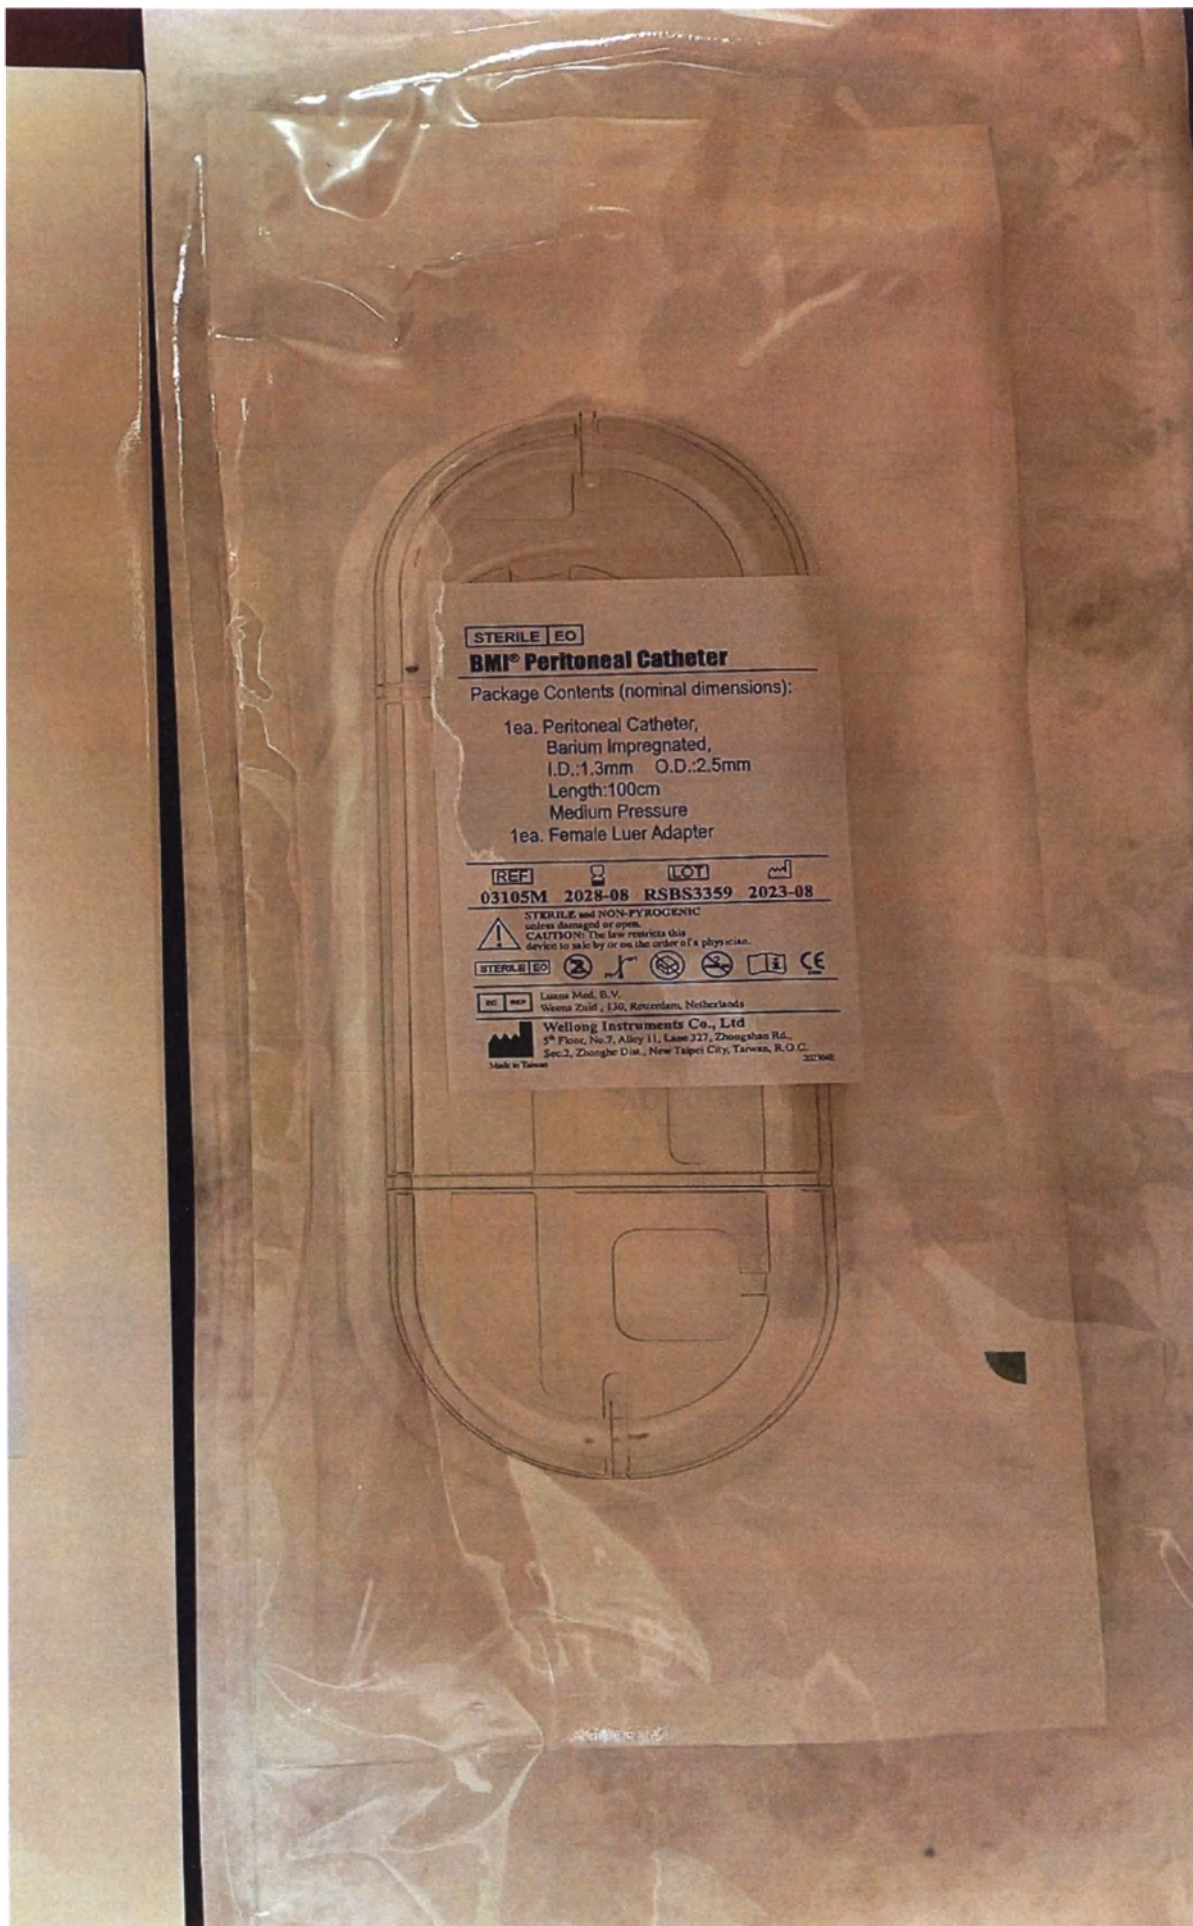

Первичная упаковка: Катетер перитонеальный, среднего давления, в составе: катетер перитонеальный среднего давления (1 шт); коннектор Luer (1 шт) (артикул 03105M)

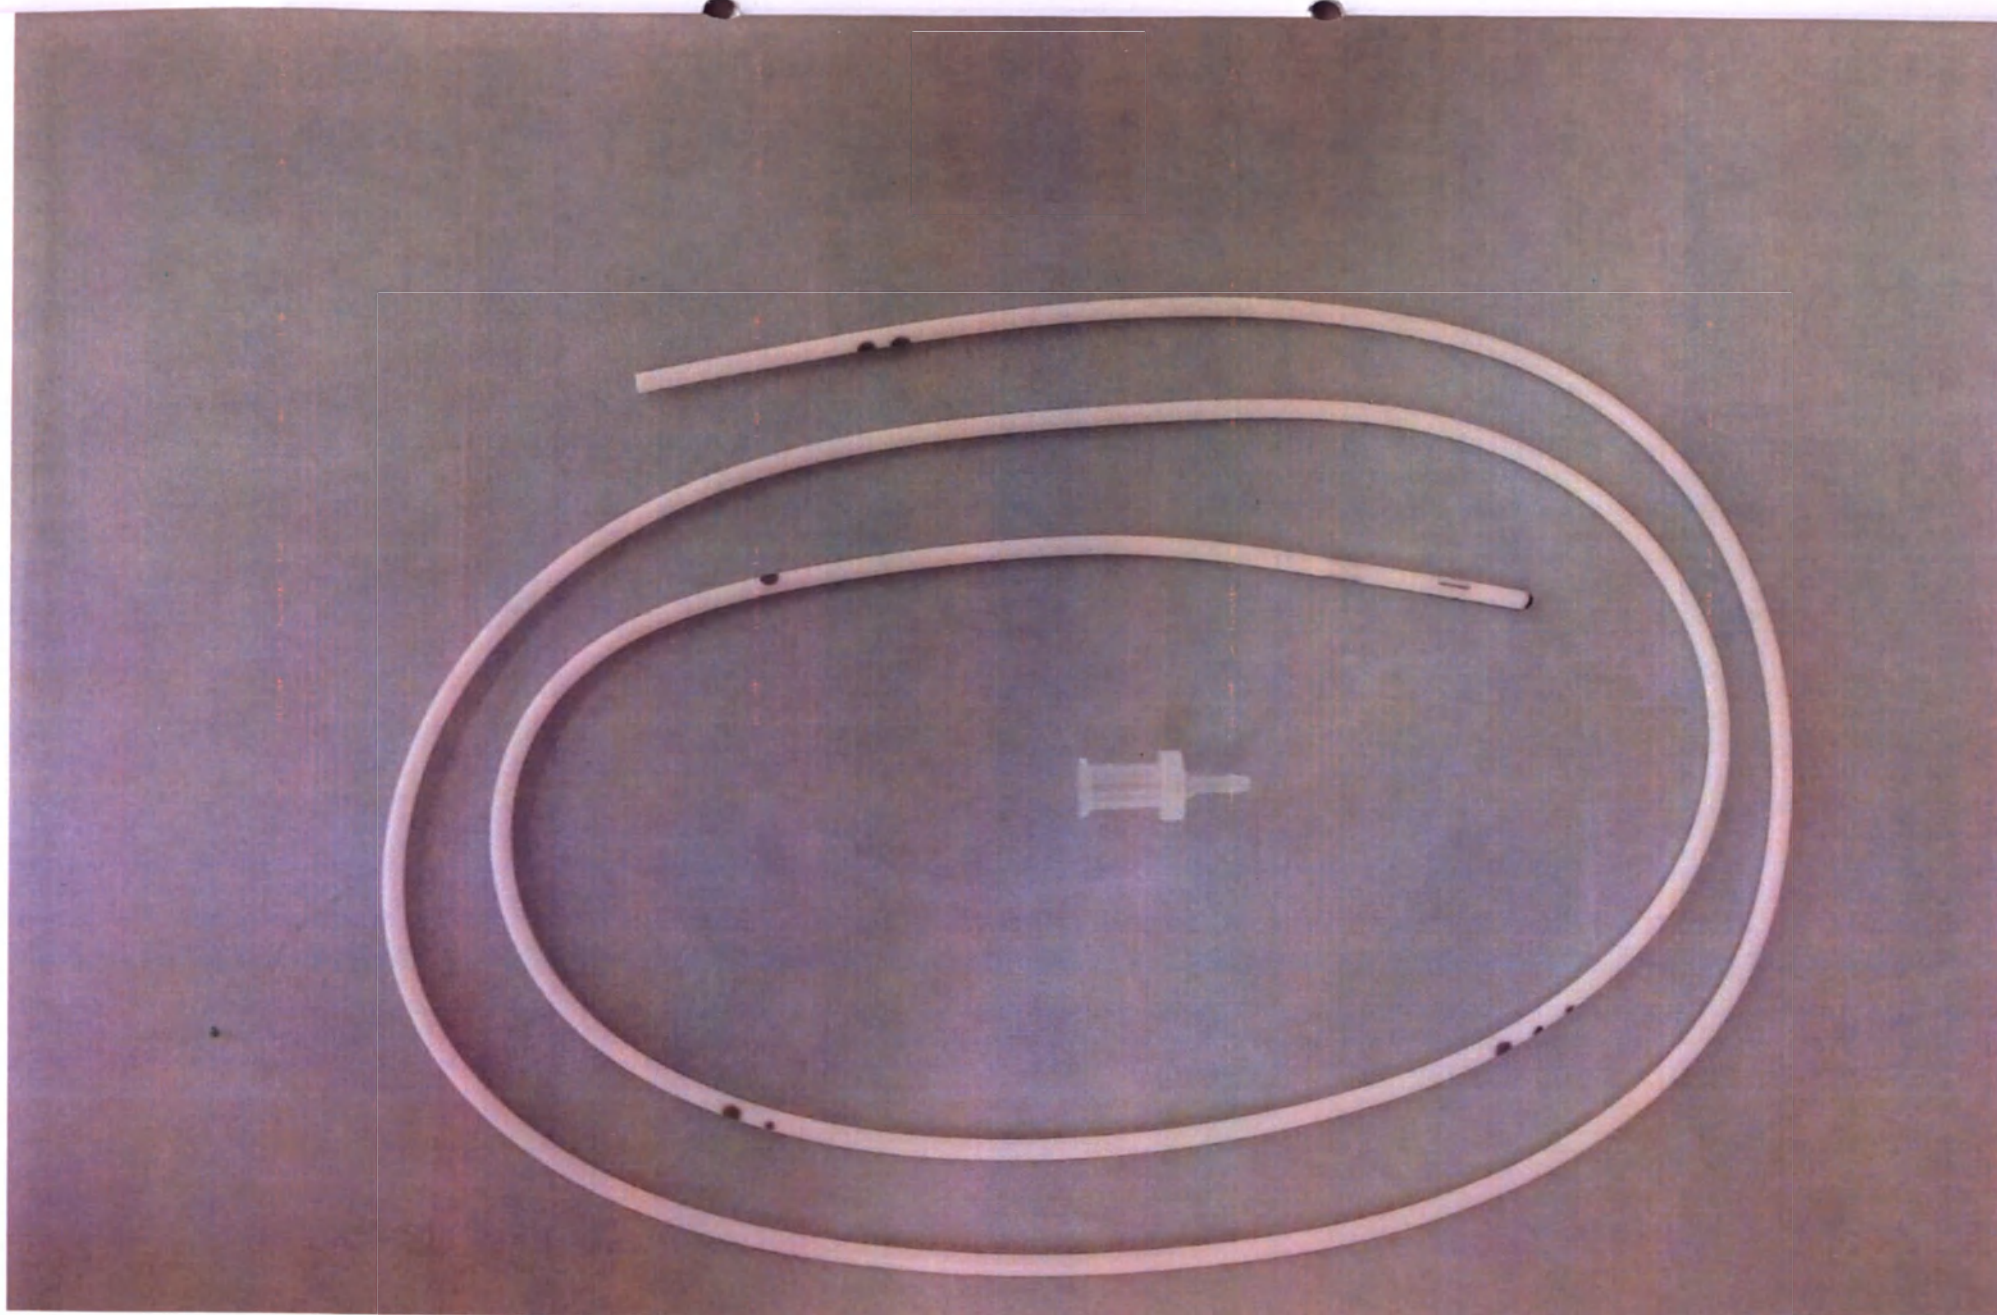

Катетер перитонеальный, среднего давления в составе: катетер перитонеальный среднего давления (1 шт); коннектор Luer (1 шт) (артикул 03105М)

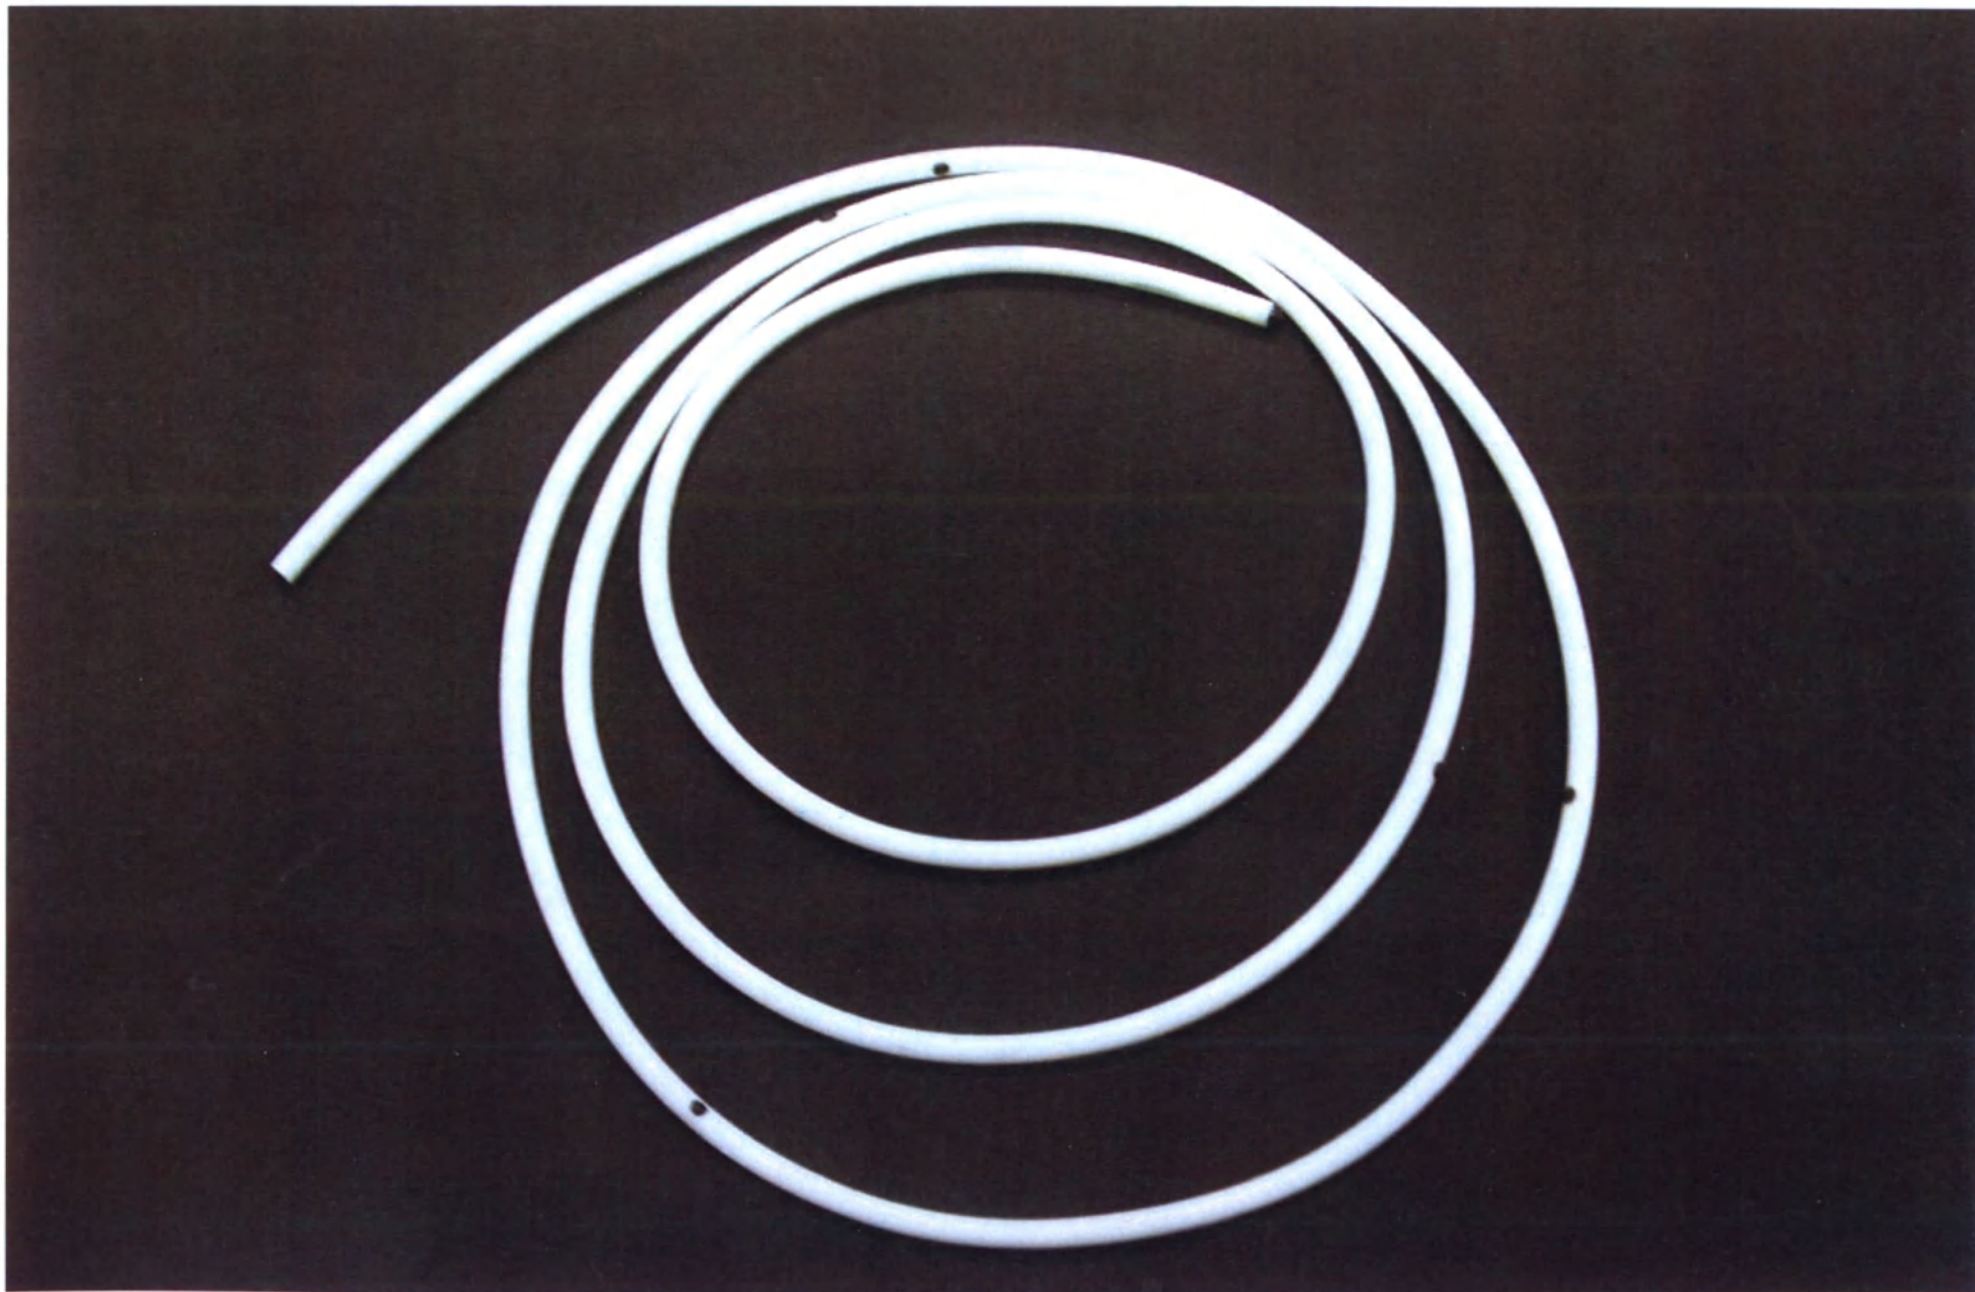

Катетер перитонеальный антибактериальный, низкого давления (артикул 23105L)

Клапан ВМІ контурный, среднего давления

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до: _____

Артикул: 02812M

Код партии: _____

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Клапан ВМІ контурный, среднего давления – 1 шт.

2. Фиксатор – 1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Пример русскоязычной маркировки изделия.

Клапан ВМІ контурный, низкого
давления, в составе

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до: _____

Артикул: 02812L+01101+23105L

Код партии: ____ + ____ + ____

Кол-во: 1 уп.

Состав упаковки:

1. Клапан ВМІ контурный, низкого давления – 1 шт.

2. Фиксатор - 1 шт.

3. Катетер вентрикулярный, в составе: катетер вентрикулярный (1 шт); стилет (1 шт) – 1 шт.

4. Катетер перитонеальный низкого давления, в составе: катетер перитонеальный низкого давления (1 шт); коннектор Luer (1 шт) – 1 шт.

5. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апирогенно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.


Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



Пример русскоязычной маркировки изделия в случае поставки совместно с изделиями «при необходимости»

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

21 (двадцать одна) лист

Директор

Чебурашкин Д.М.)

