

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«15» июня 2023 г.



Макет маркировки медицинского изделия для диагностики in vitro

«Картридж «Лидлаб Ангара Картридж» для количественного определения
кислотно-щелочного состояния, газового состава крови, гематокрита,
электролитов и метаболитов для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23–318-
65614693-2022»

Этикетка первичной упаковки

Лидлаб Ангара Картридж

Вариант исполнения – КТ465

Картридж «КТ465» – 1 шт.

Параметры тестирования картриджа:
pH/pCO2/pO2/K+/Na+/Cl-/Ca++/Hct

РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

REF	XXXXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX



ООО «ЛИДКОР»



Лидлаб Ангара Картридж

Вариант исполнения – КТ466

Картридж «КТ466» – 1 шт.

Параметры тестирования картриджа:
pH/pCO2/pO2/K+/Na+/Cl-/Ca++/Hct/Glu/Lac

РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


REF	XXXXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX



ООО «ЛИДКОР»




Макет первичной упаковки

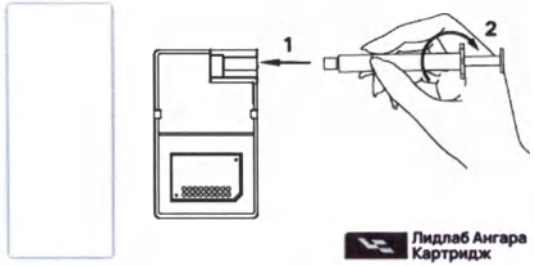

Лидлаб Ангара
Картридж







Этикетка переходника для капиллярной крови

Лидлаб Ангара Картридж

Вариант исполнения – КТ465

Переходник для капиллярной крови – 25 шт.


РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

REF	XXXXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX



ООО «ЛИДКОР»







Лидлаб Ангара Картридж Вариант исполнения – КТ466

Переходник для капиллярной крови – 25 шт.

ООО «ЛИДКОР»

РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX			
REF	XXXXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX



Этикетка потребительской (транспортной) упаковки

Лидлаб Ангара Картридж Вариант исполнения – КТ466

Состав:

1. Картридж «КТ466» – 25 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Аналитический паспорт – 1 шт.
4. Переходник для капиллярной крови – 25 шт.

РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX			
	XX.XX.XXXX	LOT	XXXXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX	REF	XXXXXXXXXXXX

Масса нетто:

Масса брутто:

Место производства

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Ангара Картридж Вариант исполнения – КТ465

Состав:

1. Картридж «КТ465» – 25 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Аналитический паспорт – 1 шт.
4. Переходник для капиллярной крови – 25 шт.

РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX			
	XX.XX.XXXX	LOT	XXXXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX	REF	XXXXXXXXXXXX

Масса нетто:


Масса брутто:

Место производства

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Макет маркировки потребительской (транспортной) упаковки

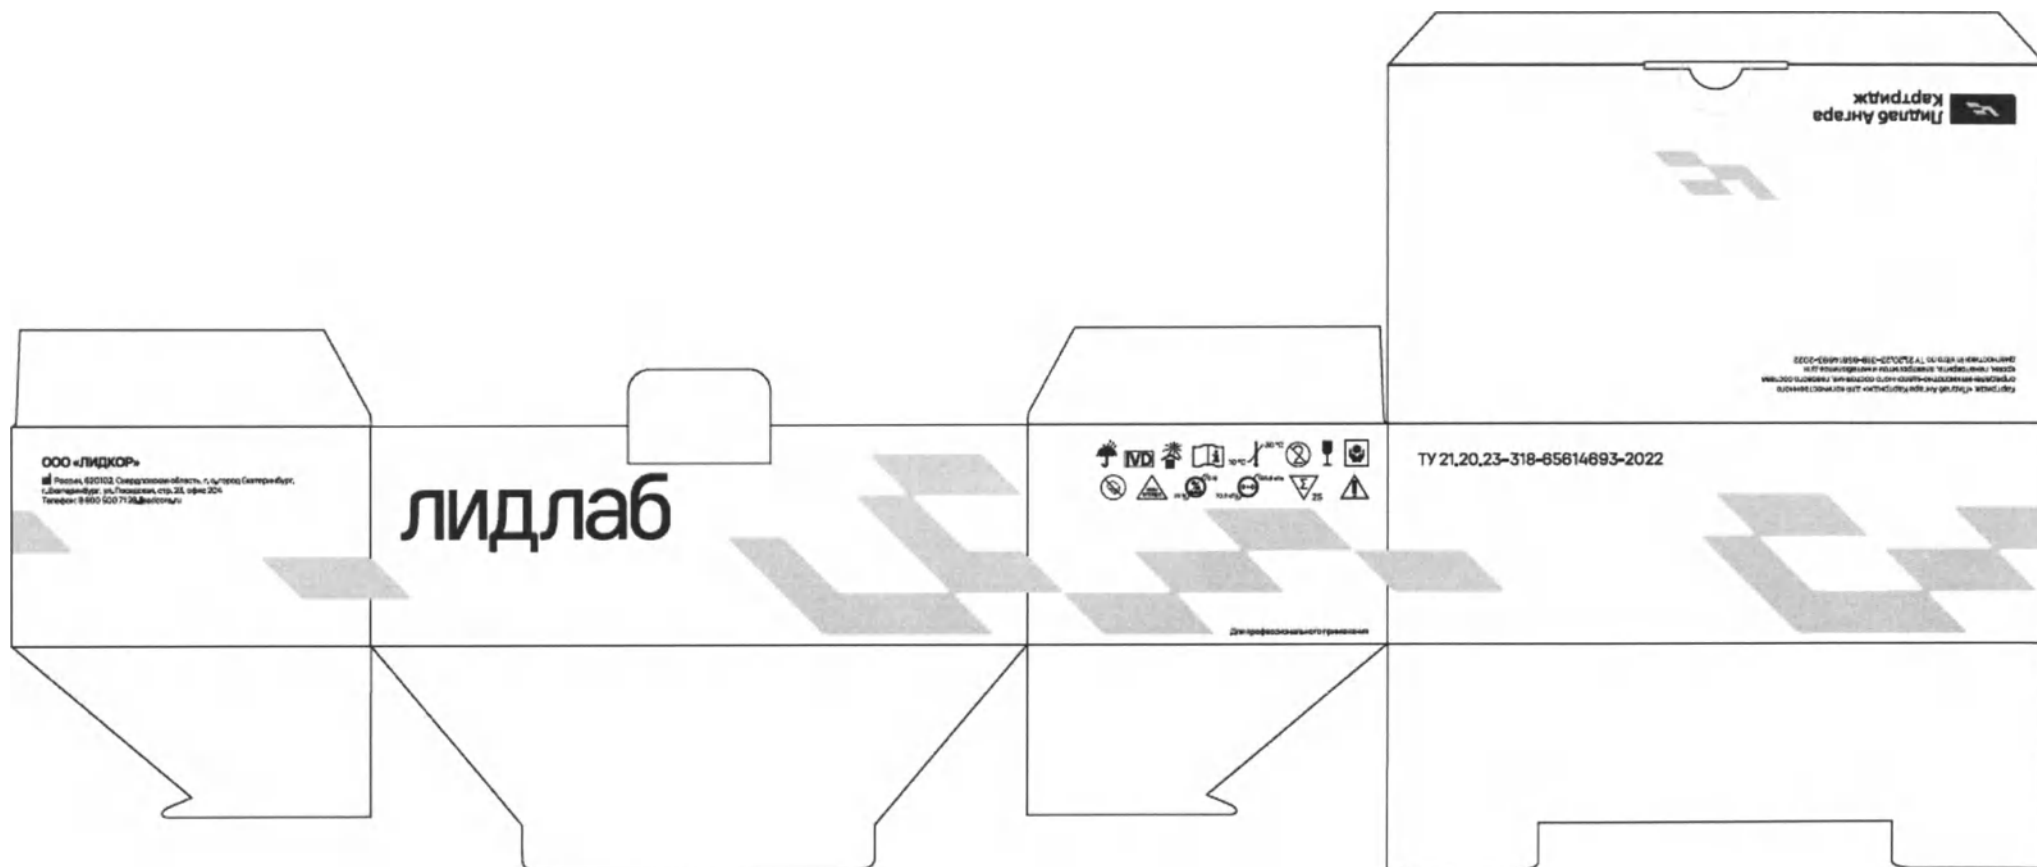

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 (четыре) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»
/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"


Е.Ю. Гохгут




**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для
диагностики in vitro**

«Картридж «Лидлаб Ангара Картридж» для количественного определения
кислотно-щелочного состояния, газового состава крови, гематокрита,
электролитов и метаболитов для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23–318-
65614693-2022»

Картридж «КТ465»

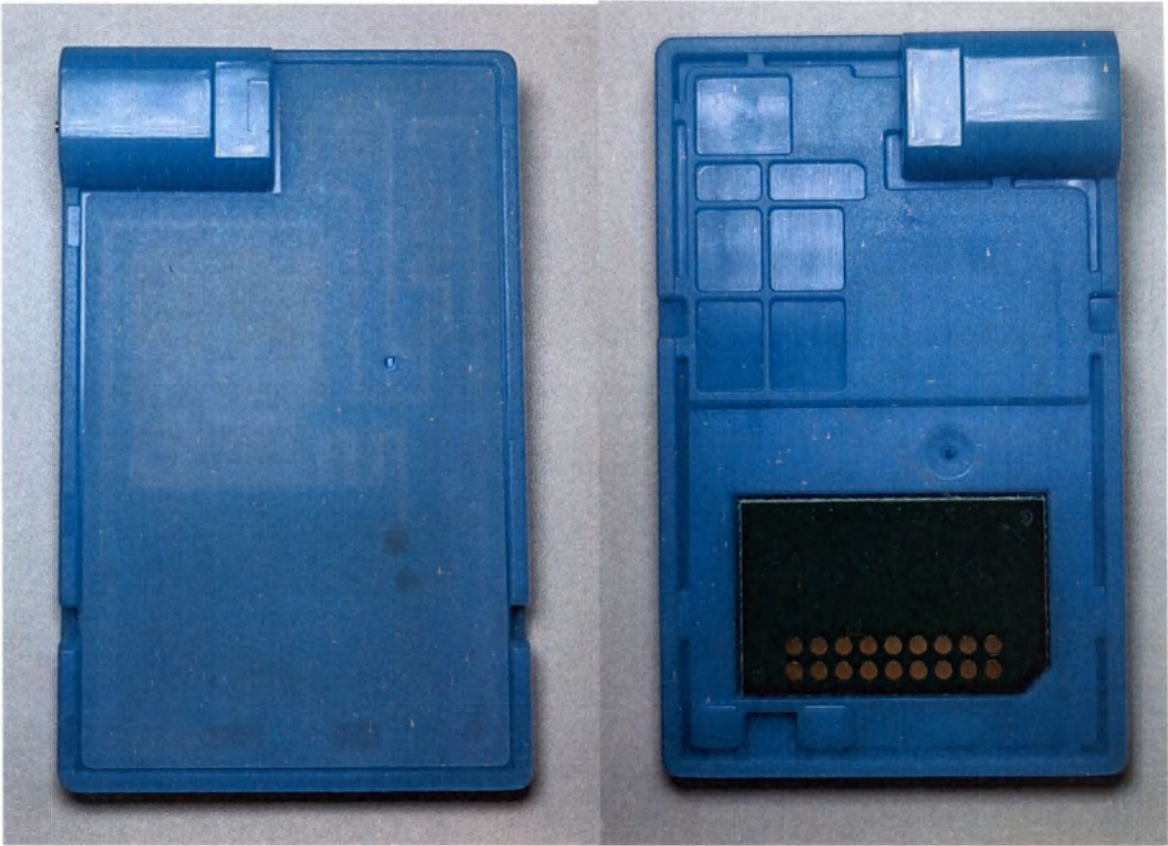

Картридж «КТ466»

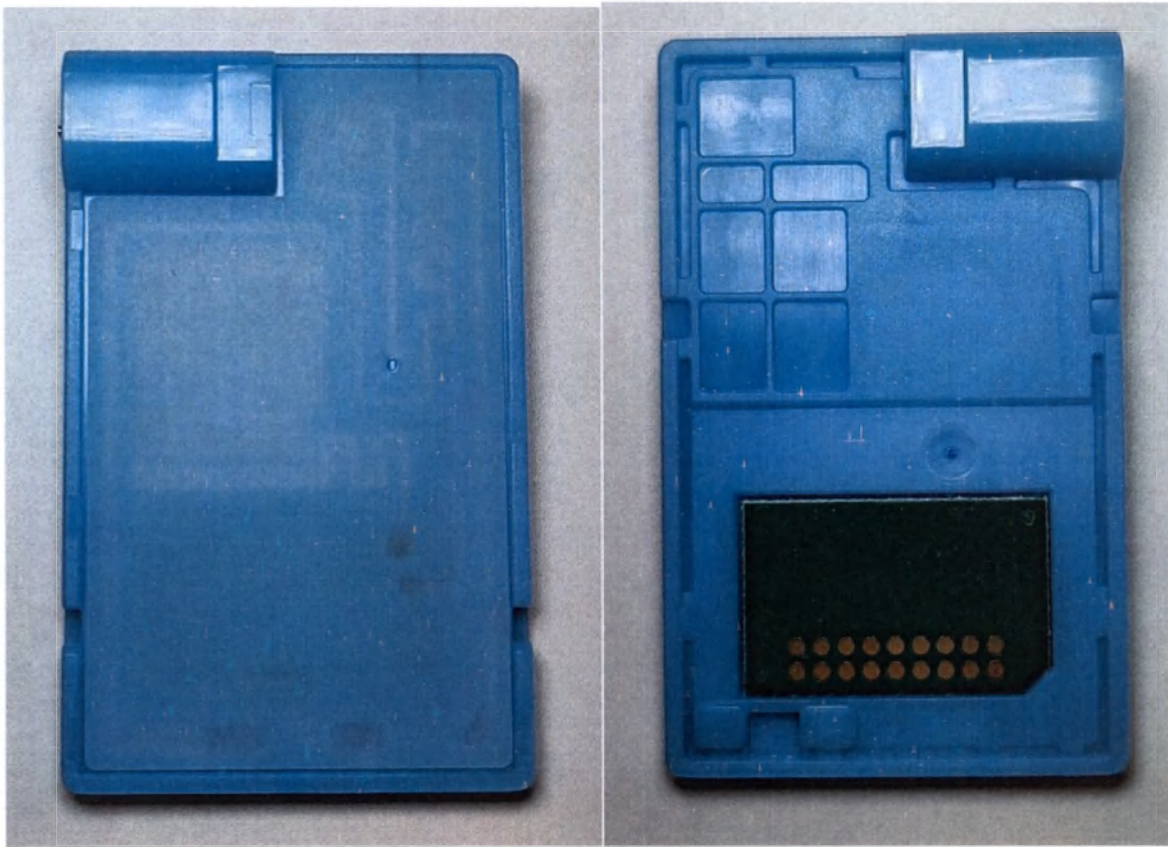


Переходник для капиллярной крови (Вариант исполнения – КТ465)





Переходник для капиллярной крови (Вариант исполнения – КТ466)



Первичная упаковка картриджа «КТ465». Вид спереди

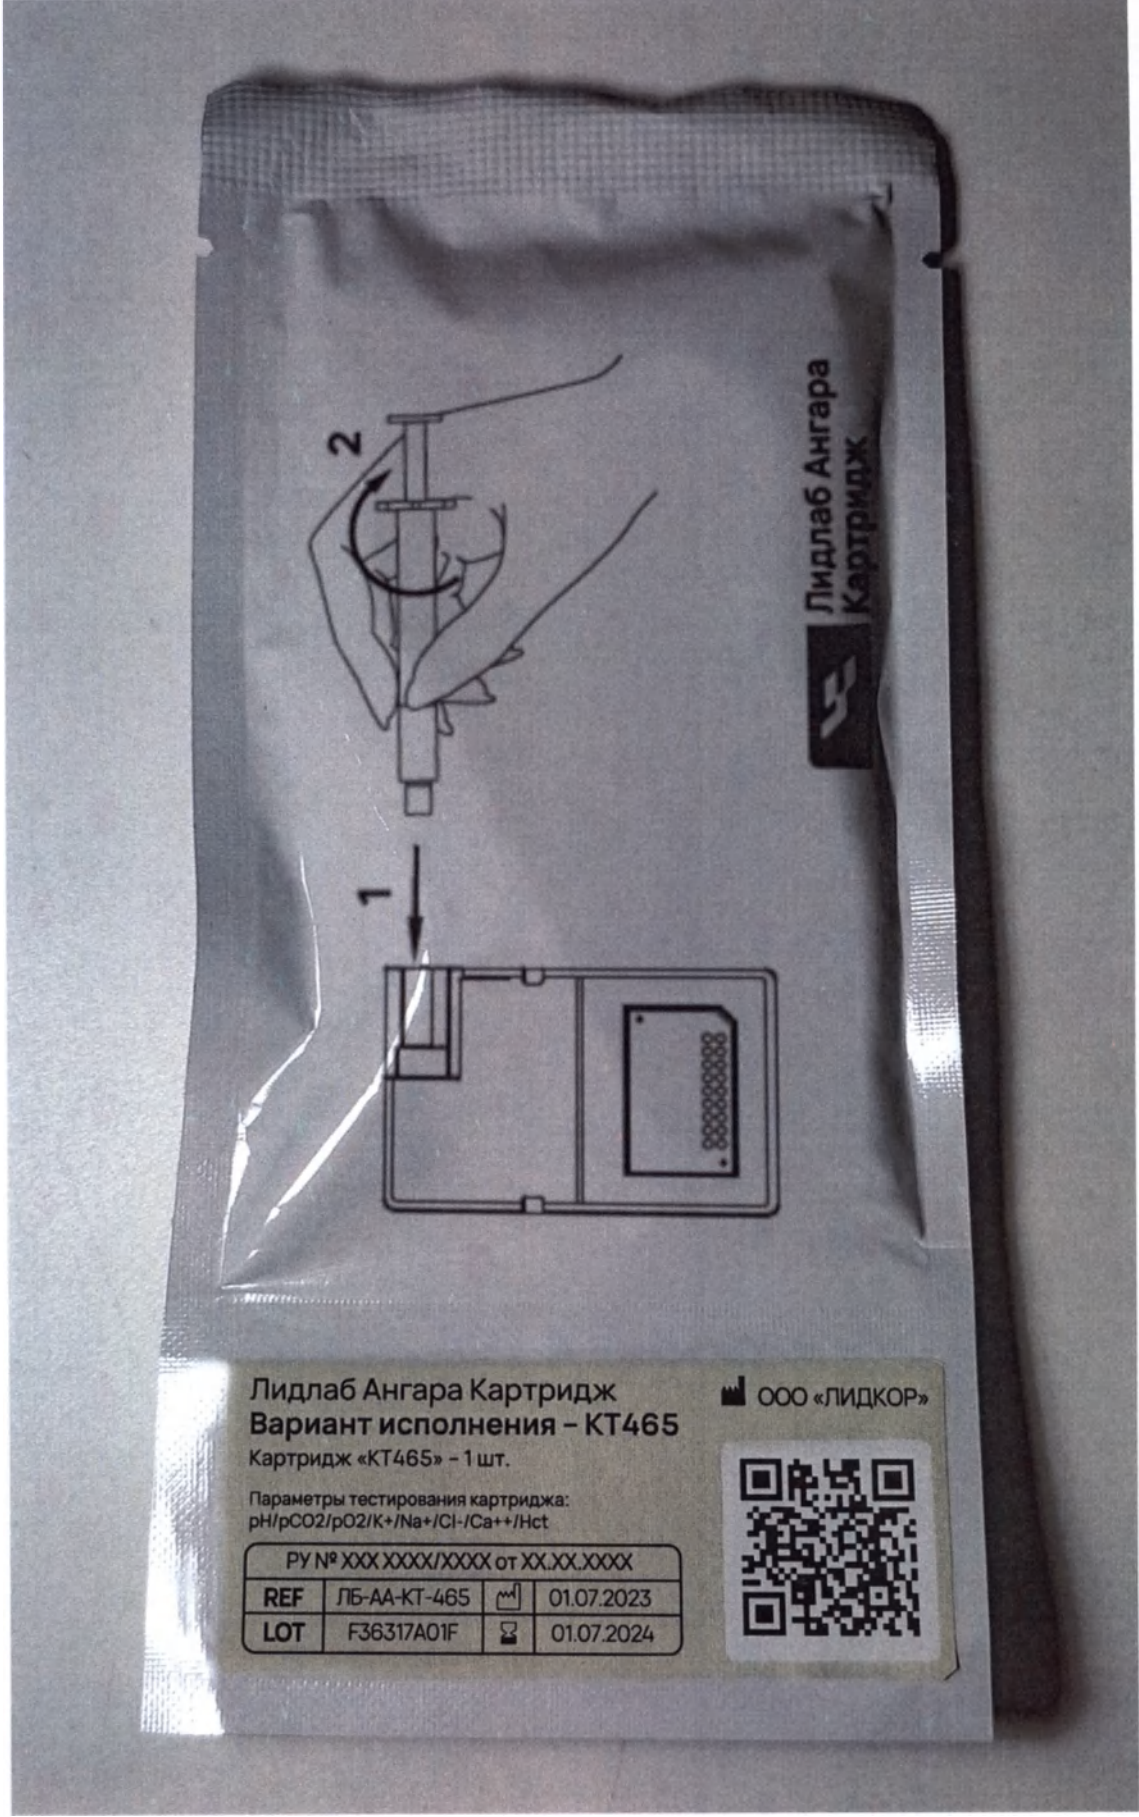

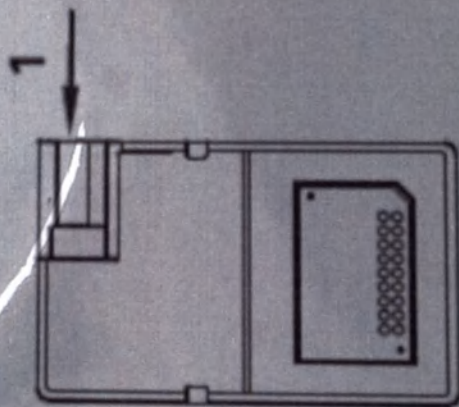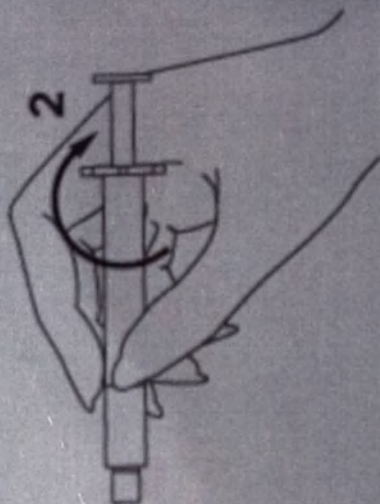

Лидлаб Ангара
Картридж



Лидлаб Ангара Картридж
Вариант исполнения – КТ465
Картридж «КТ465» – 1 шт.

ООО «ЛИДКОР»


Параметры тестирования картриджа:
pH/pCO2/pO2/K+/Na+/Cl-/Ca++/Hct

РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX			
REF	ЛБ-АА-КТ-465		01.07.2023
LOT	F36317A02F		01.07.2024




Первичная упаковка картриджа «КТ466». Вид спереди



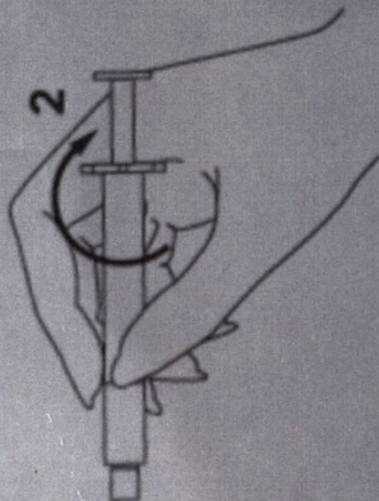

1

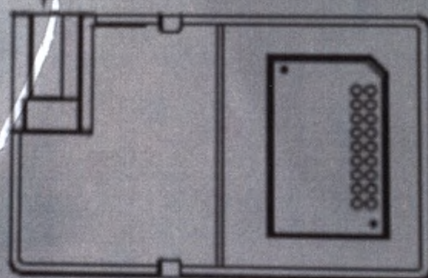

Лидлаб Ангара
Картридж



Лидлаб Ангара Картридж
Вариант исполнения - КТ466
Картридж «КТ466» - 1 шт.

Параметры тестирования картриджа:
pH/pCO2/pO2/K+/Na+/Cl-/Ca++/Hct/Glu/Lac

РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX					
REF	ЛБ-АА-КТ-466	м	01.10.2023		
LOT	F36417B03H	д	01.07.2024		

ООО «ЛИДКОР»



Первичная упаковка картриджа «КТ465». Вскрытая упаковка





Лидлаб Ангара Картридж
Вариант исполнения – КТ465
Переходник для капиллярной крови – 25 шт.

ООО «ЛИДКОР»

ПУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

REF	ЛБ-АА-КТ-465	мг	01.07.2023
LOT	F36317A02F	г	01.07.2024



Переходник для капиллярной крови – 25 шт. (Вариант исполнения – КТ466»)





Потребительская упаковка. Вариант исполнения – КТ465. Вид сверху.

Картридж «Лидлаб Ангара Картридж» для количественного определения кислотно-щелочного состояния, газового состава крови, гематокрита, электролитов и метаболитов для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-318-65614693-2022

Лидлаб Ангара Картридж
Вариант исполнения – КТ465

РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX			
	01.07.2023	LOT	F36317A01F
	01.07.2024	REF	ЛБ-АА-КТ-465

Состав:
1. Картридж «КТ465» – 25 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Аналитический паспорт – 1 шт.
4. Переходник для капиллярной крови – 25 шт.



Масса нетто:

Масса брутто:

 Место производства

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, За



Лидлаб Ангара
Картридж

Картридж «Лидлаб Ангара Картридж» для количественного определения кислотно-щелочного состояния, газового состава крови, гематокрита, электролитов и метаболитов для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-318-65614693-2022

Лидлаб Ангара Картридж
Вариант исполнения – КТ465

РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX			
01.07.2023	LOT	F36317A02F	
01.07.2024	REF	ЛБ-АА-КТ-465	

Масса нетто:

Масса брутто:

☒ Место производства


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Состав:
1. Картридж «КТ465» – 25 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Ассортиментный паспорт – 1 шт.
4. Переходник для капиллярной крови – 25 шт.



Лидлаб Ангара
Картридж

Потребительская упаковка. Вариант исполнения – КТ466. Вид сверху.

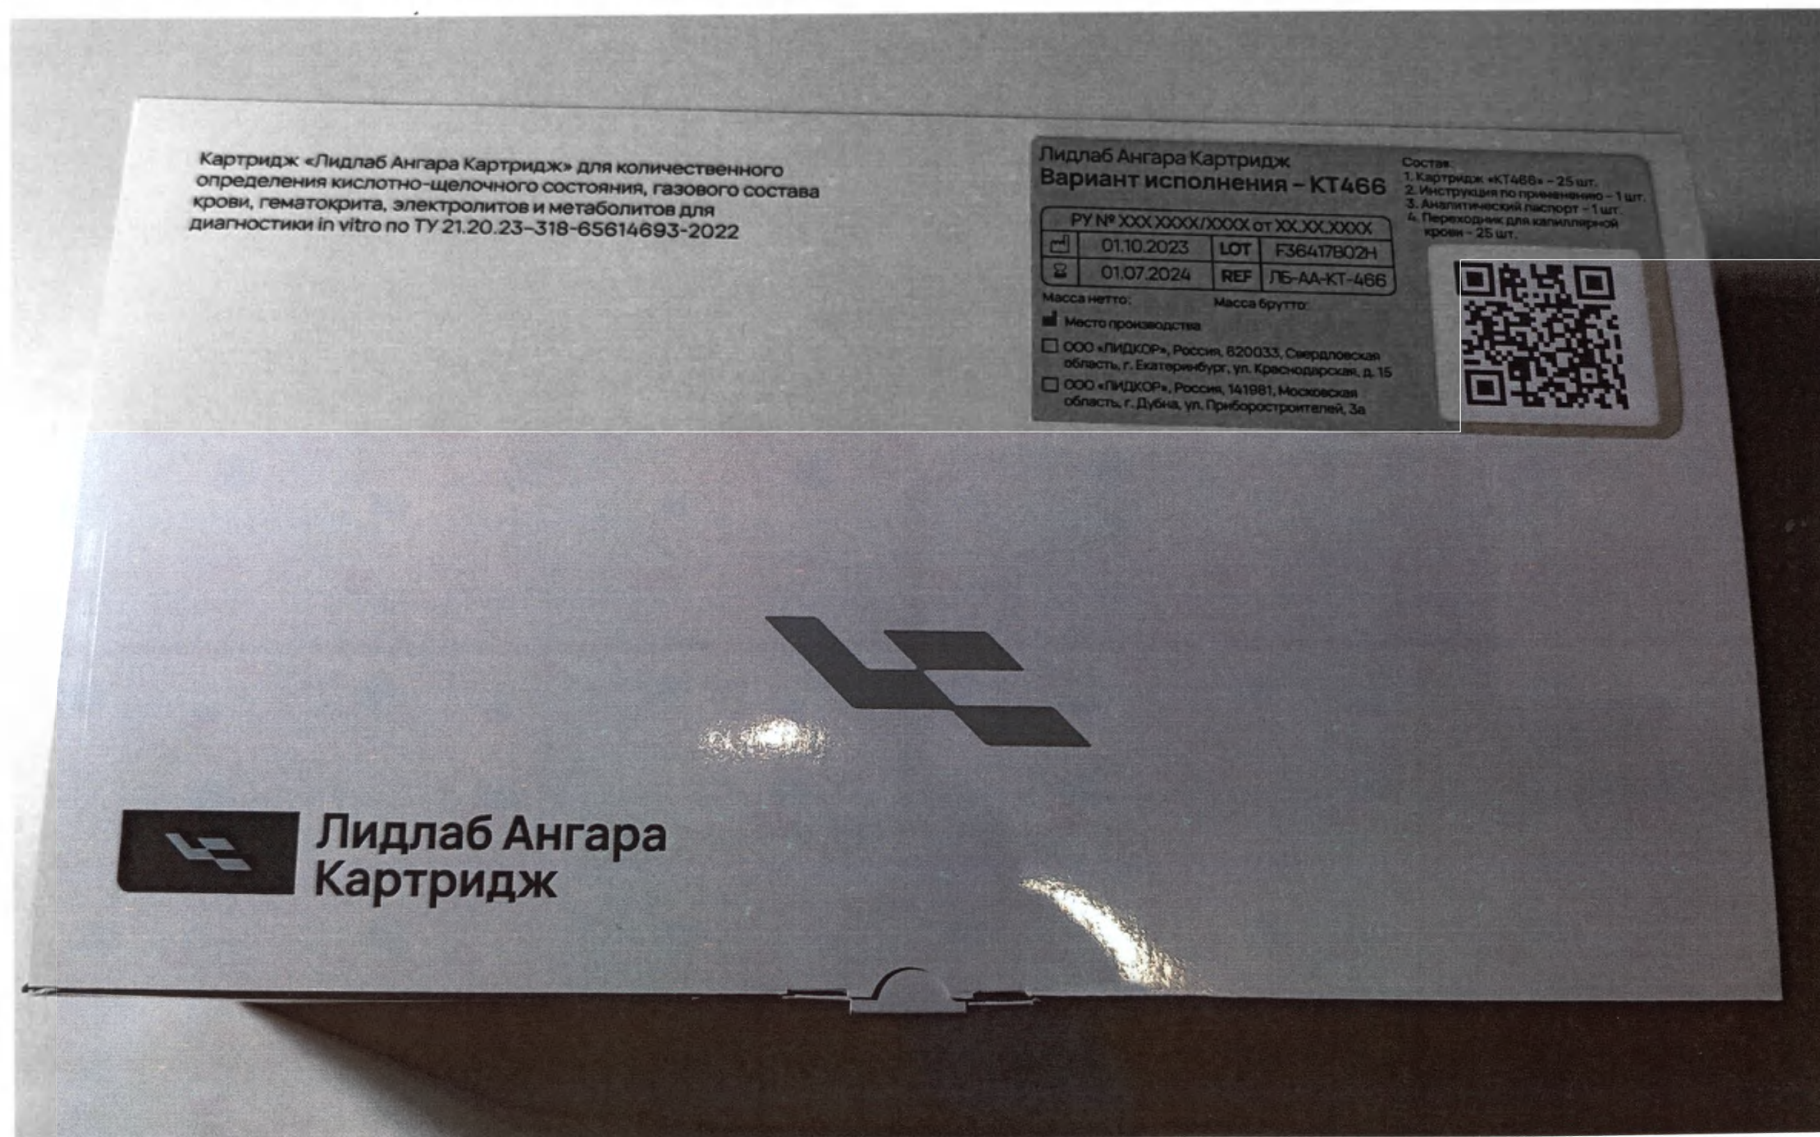

Картридж «Лидлаб Ангара Картридж» для количественного определения кислотно-щелочного состояния, газового состава крови, гематокрита, электролитов и метаболитов для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-318-65614693-2022

Лидлаб Ангара Картридж
Вариант исполнения – КТ466

РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX			
	01.10.2023	LOT	F36417B03H
	01.07.2024	REF	ЛБ-АА-КТ-466

Масса нетто:

Масса брутто:

☒ Место производства

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141881, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Состав:
1. Картридж «КТ466» – 25 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Аналитический паспорт – 1 шт.
4. Переходник для капиллярной крови – 25 шт.



Лидлаб Ангара
Картридж

Потребительская упаковка. Вариант исполнения – КТ465. Вид спереди.





Картридж не «Лидлаб Ангара» не является и не должен использоваться в качестве замены оригинального картриджа. Использование картриджа в качестве замены оригинального картриджа может привести к повреждению оборудования и снижению качества печати. Гарантия на картридж действует в течение 12 месяцев со дня выпуска. Для получения информации о гарантии и условиях использования картриджа обратитесь к руководству пользователя.



Лидлаб Ангара
Картридж



Лидлаб

Лидлаб Ангара Картридж
Вариант исполнения – КТ4В5

№	Дата выпуска	Лот	Серия	Модель
1	01.07.2023	1001	1001	КТ4В5
2	01.07.2023	1002	1002	КТ4В5

Модель: КТ4В5
Серия: 1001
Лот: 1001
Дата выпуска: 01.07.2023

ООО «Лидлаб Ангара»
141981, Московская обл., г. Видное, ул. Рудневская, 34

Состав:
1. Картридж КТ4В5 – 1 шт.
2. Руководство пользователя – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

Объем: 100 стр.


Потребительская упаковка. Вариант исполнения – КТ466. Вид спереди.




Потребительская упаковка. Вид сзади.



Потребительская упаковка. Вид слева.

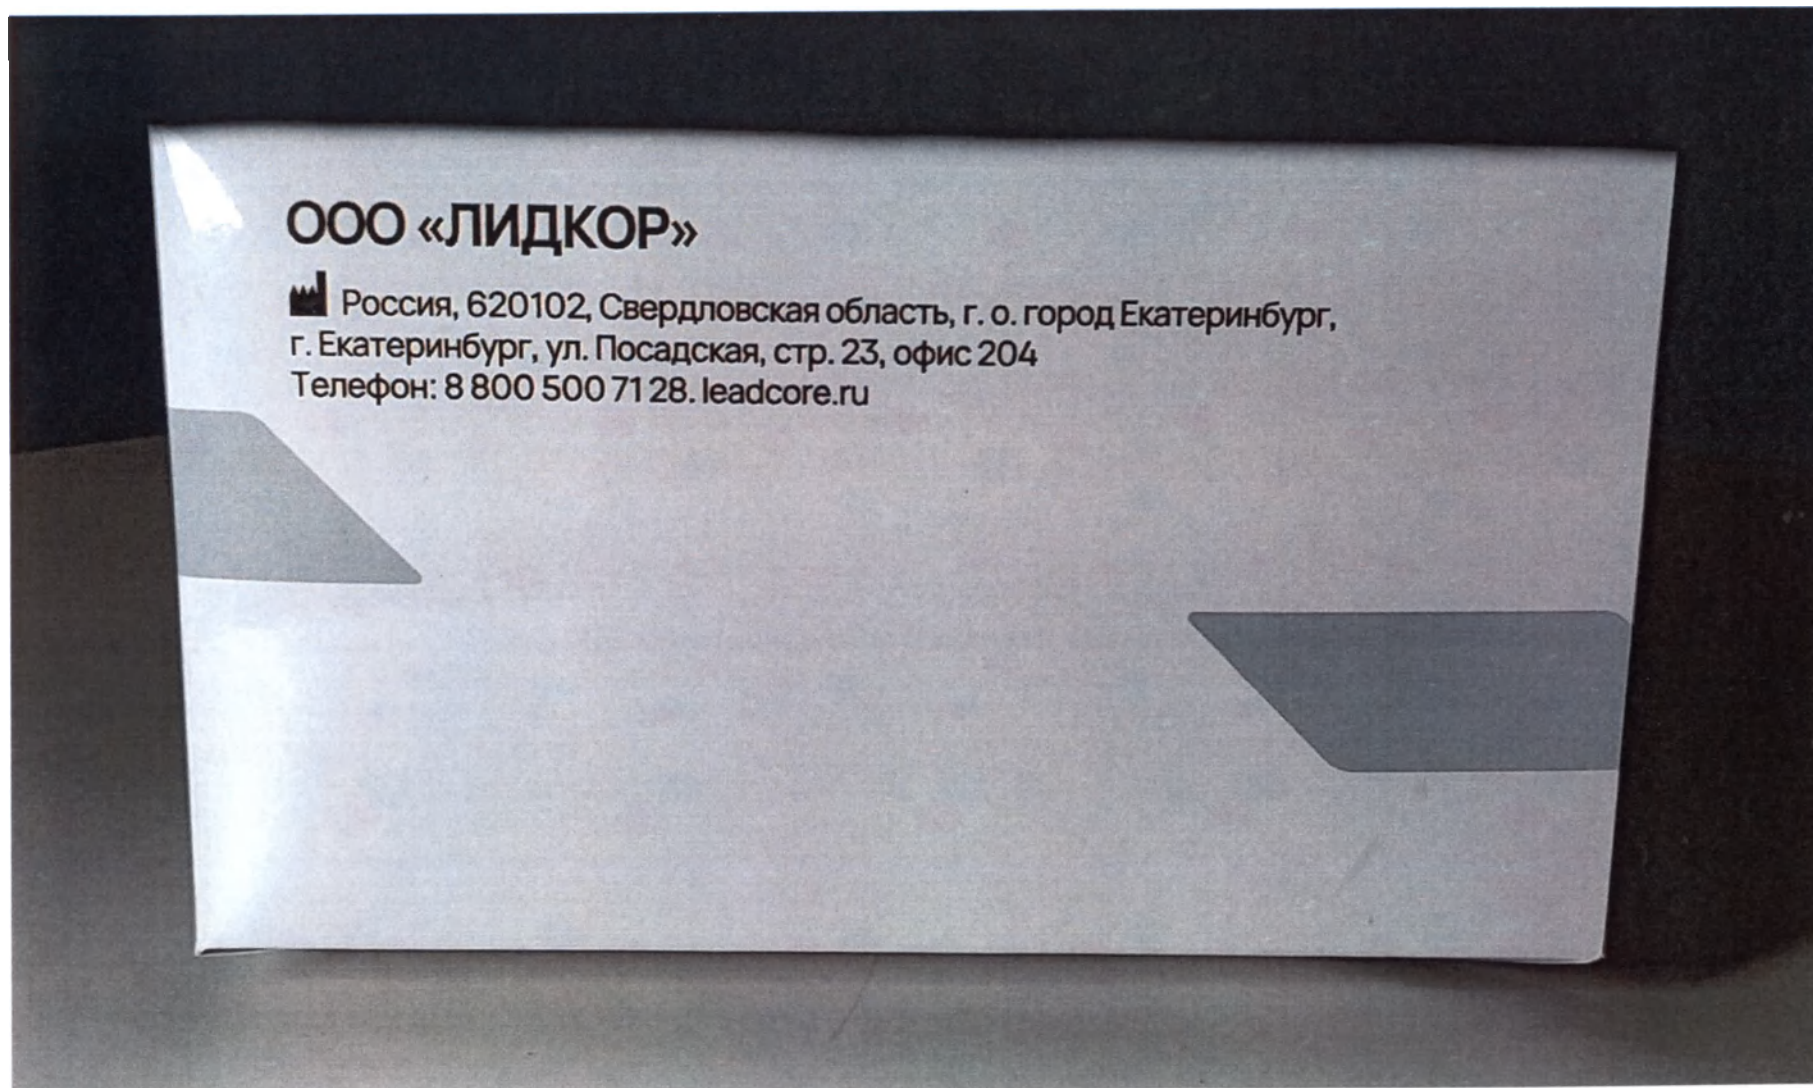

Потребительская упаковка. Вид справа.

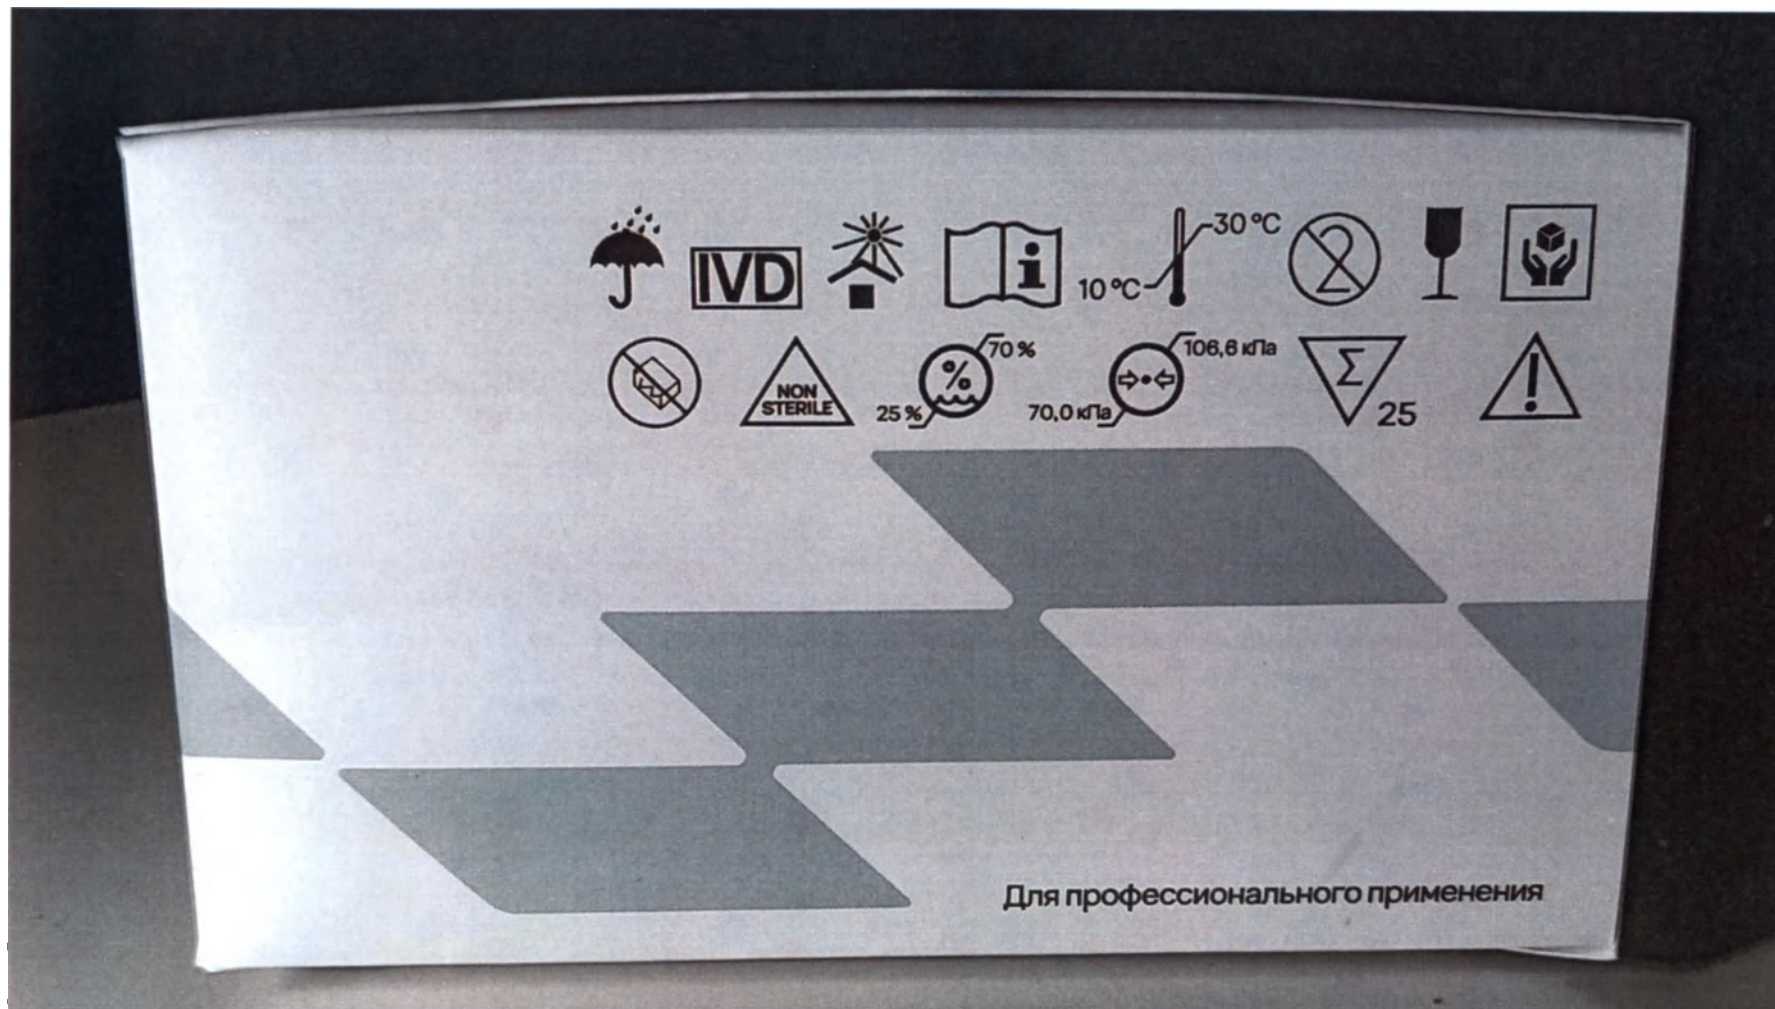

Потребительская упаковка. Вид сзади.



Фотографическое изображение общего вида. Вариант исполнения –КТ465.





Фотографическое изображение общего вида. Вариант исполнения –КТ466.





Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
29 (двадцать девять) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»
_____/Е. Ю. Гохгут/

