

«УТВЕРЖДАЮ»
ООО «Здоровье»
Ю.В.Науман
« 24 » июня 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Система Микроволновой Абляции Dorphi

Система микроволновой абляции Dorphi. в составе:


1) Генератор для микроволновой абляции Dorphi
Вид спереди:



Вид сзади:



Кабель питания генератора:

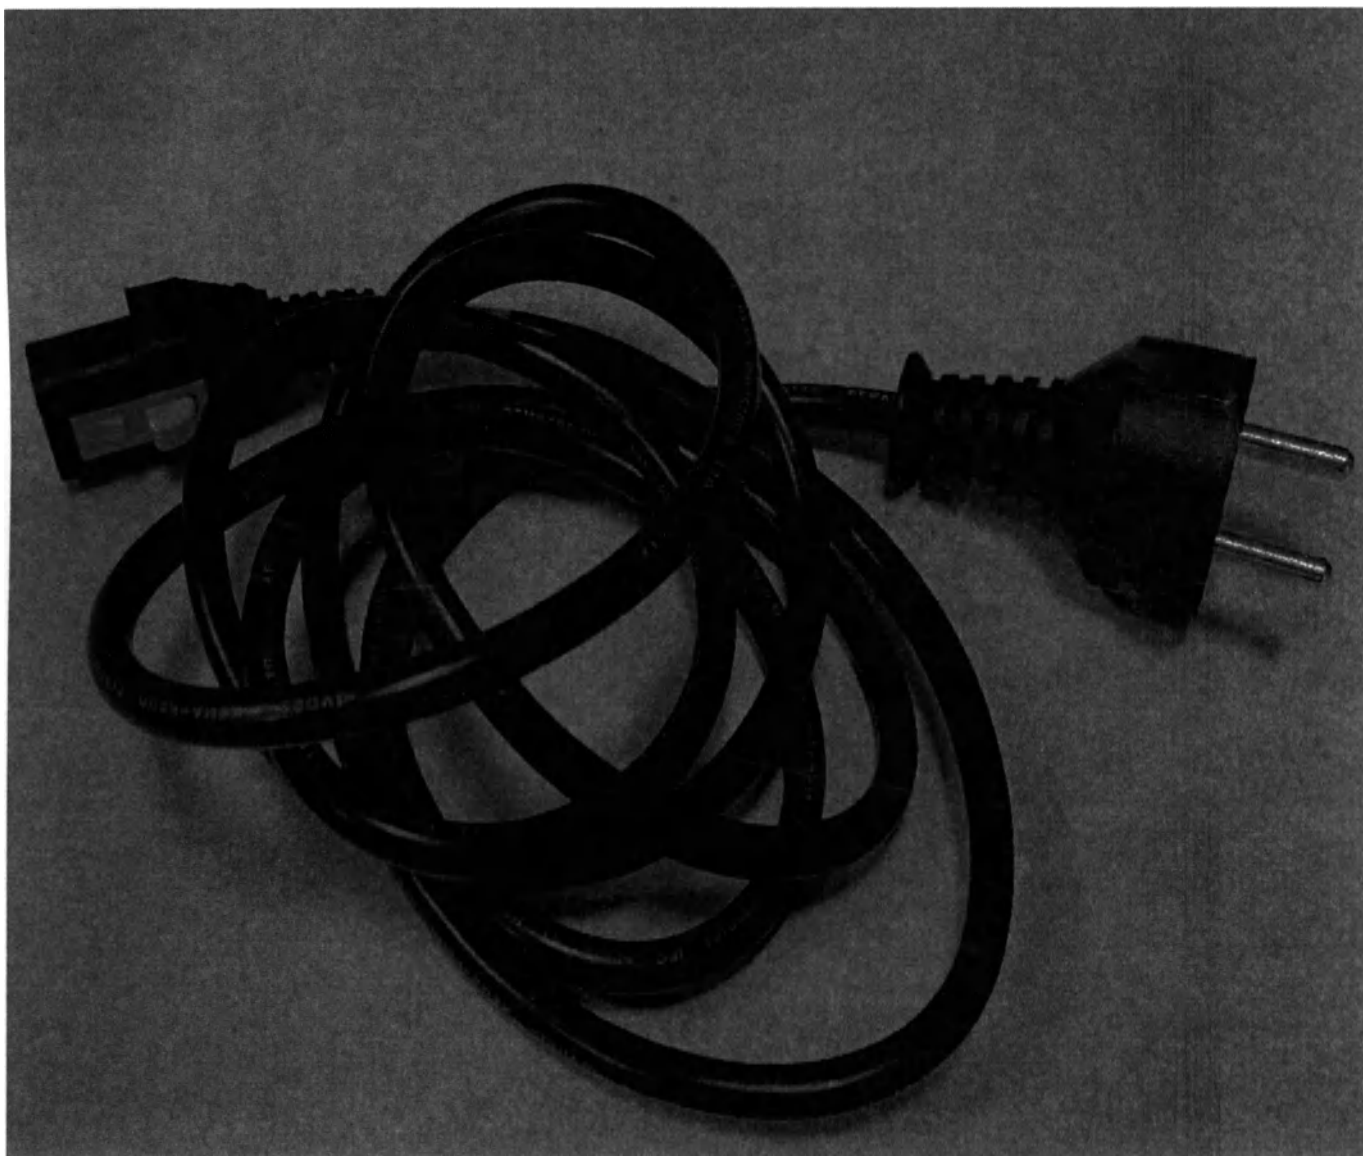

Макет маркировки на задней панели генератора:

MW Ablation Generator

SURGNOVA

REF M150E

SN XXXXXXXXXXXXX

YY YYYY-MM-DD

100-240VAC 50/60Hz 300VA



(01) 0 6972304 75029 2

(11) YYMMDD

(21) XXXXXXXXXXXXX

Mode of Operation: Intermittent use. 15 minutes on/15 minutes off.



Surgnova Healthcare Technologies(Zhejiang) Co.,Ltd.
No.1 Xinxing Yilu Road, Emerging Industrial Cluster Area,
Zonghan Subdistrict, Cixi City, Zhejiang, China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Rx ONLY

UK Responsible
Person

Wings Medical(U.K.) Limited
9a Burroughs Gardens, London, United Kingdom, NW4 4AU



Макет стикера для генератора:

Система микроволновой абляции Dophi, в составе: Генератор для микроволновой абляции Dophi в составе с руководством по эксплуатации	
Производитель:	Сургнова Хелскеа Текнолоджиз (Чжэцзян) Ко. Лтд. Surgnova Healthcare Technologies (Zhejiang) Co. Ltd. No.1 Xinxing Yilu Road, Emerging Industrial Cluster Area, Zonghan Subdistrict, Cixi city, Zhejiang, 315301, China
Представитель производителя в РФ:	Общество с Ограниченной Ответственностью «Здоровье» 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, пом./ком. IV/9,10
Регистрационное Удостоверение № _____ от _____	

2) Зонд температурный Dophi


Зонд внутри первичной (стерильной) упаковки:




Зонд без первичной (стерильной) упаковки:



Первичная упаковка зонда:

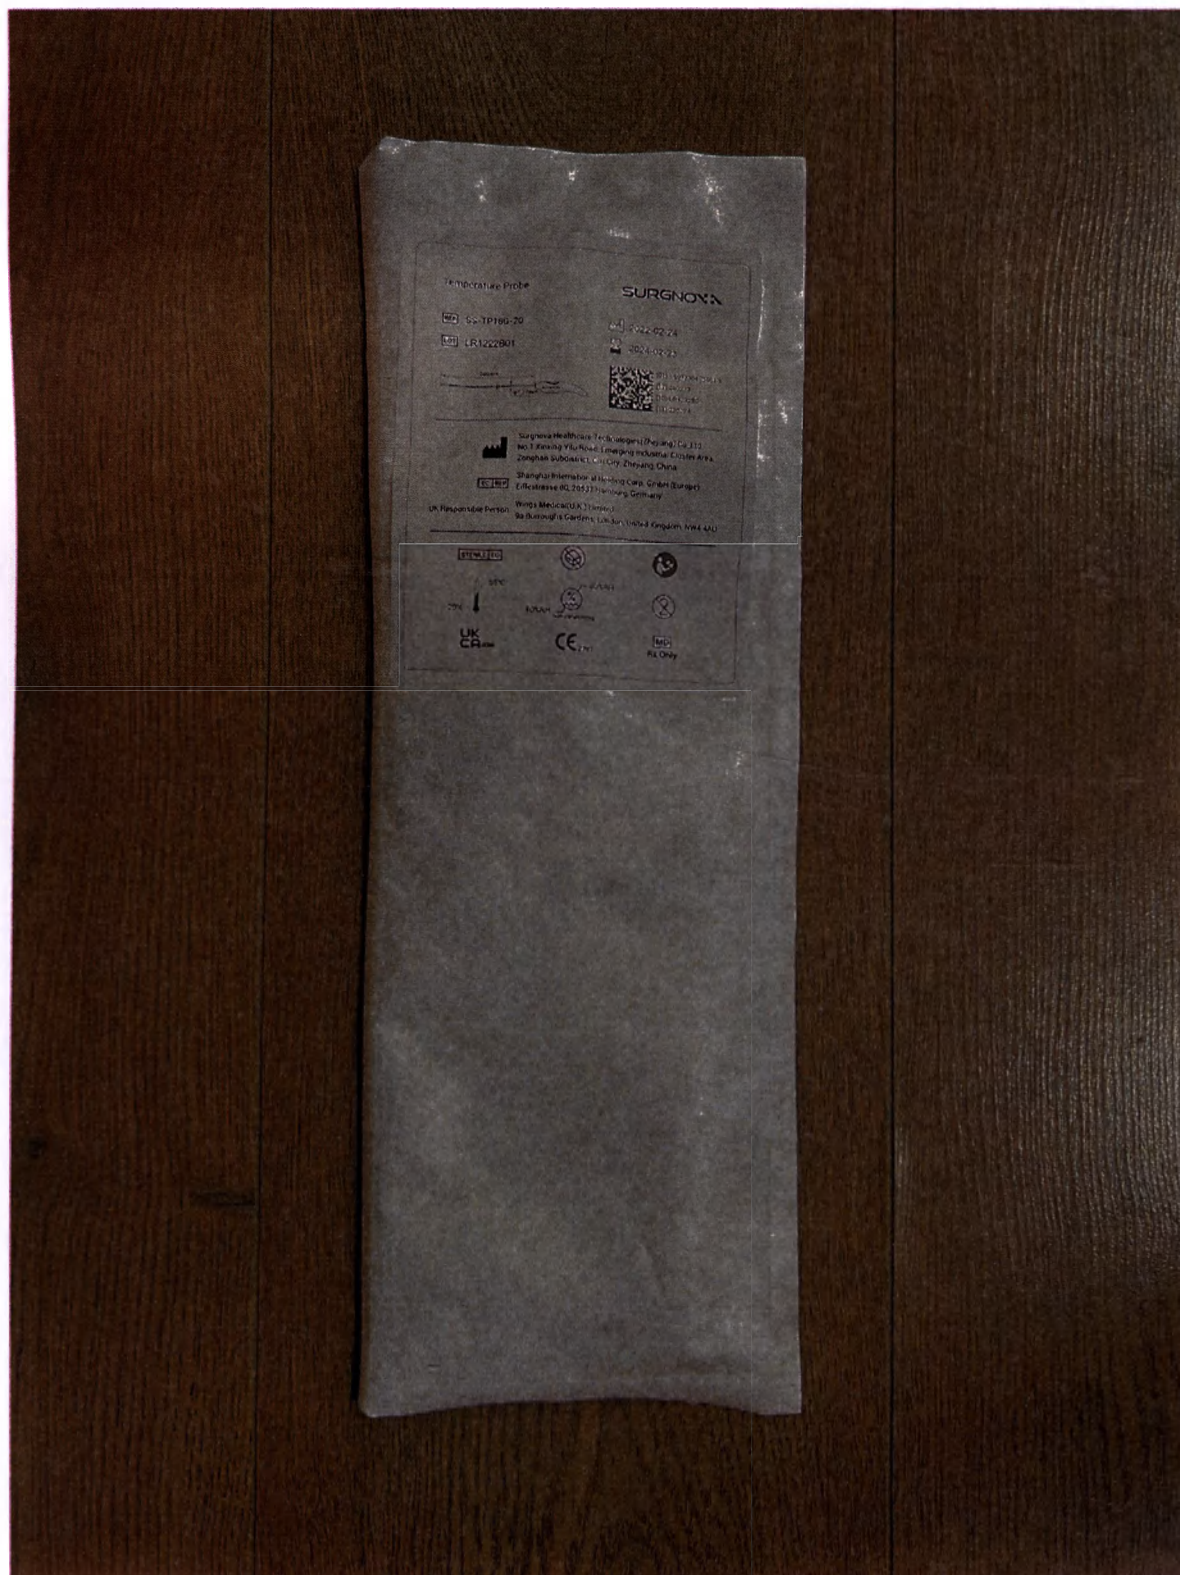

Вторичная упаковка зонда:

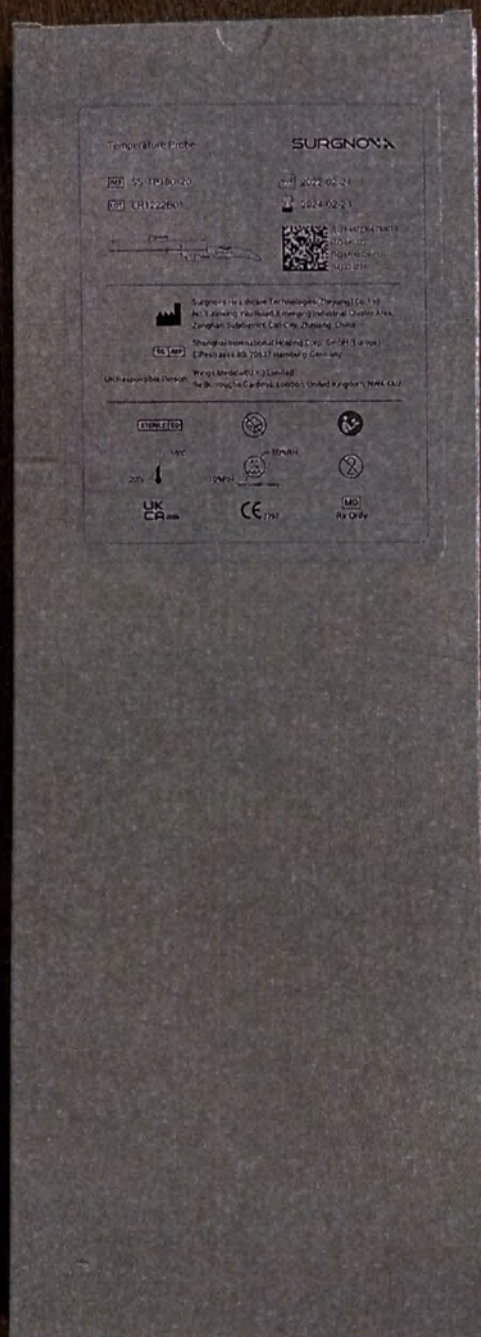

Макет маркировки на первичной и вторичной упаковках зонда:

Temperature Probe


SURGNOVA

REF SS-TP18G-20

 YYYY-MM-DD

LOT LXXXXXXXX

 YYYY-MM-DD



(01) 1 6972304 75001 5

(17) YYMMDD

(10) LXXXXXXXX

(11) YYMMDD



Surgnova Healthcare Technologies(Zhejiang) Co.,Ltd.
No.1 Xinxing Yilu Road, Emerging Industrial Cluster Area,
Zonghan Subdistrict, Cixi City, Zhejiang, China



EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

UK Responsible Person

Wings Medical(U.K.) Limited
9a Burroughs Gardens, London, United Kingdom, NW4 4AU

STERILE EO



**UK
CA** 0006

CE 2797

MD
Rx Only


Макет стикера для зонда:

Система микроволновой абляции Dorhi, в составе: Зонд температурный Dorhi в составе с инструкцией по применению	
Производитель:	Сургнова Хелскеа Текнолоджиз (Чжэцзян) Ко. Лтд. Surgnova Healthcare Technologies (Zhejiang) Co. Ltd. No.1 Xinxing Yilu Road, Emerging Industrial Cluster Area, Zonghan Subdistrict, Cixi city, Zhejiang, 315301, China
Представитель производителя в РФ:	Общество с Ограниченной Ответственностью «Здоровье» 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, пом./ком. IV/9,10
Регистрационное Удостоверение № _____ от _____	

3) Педаль ножная:



Макет маркировки педали:

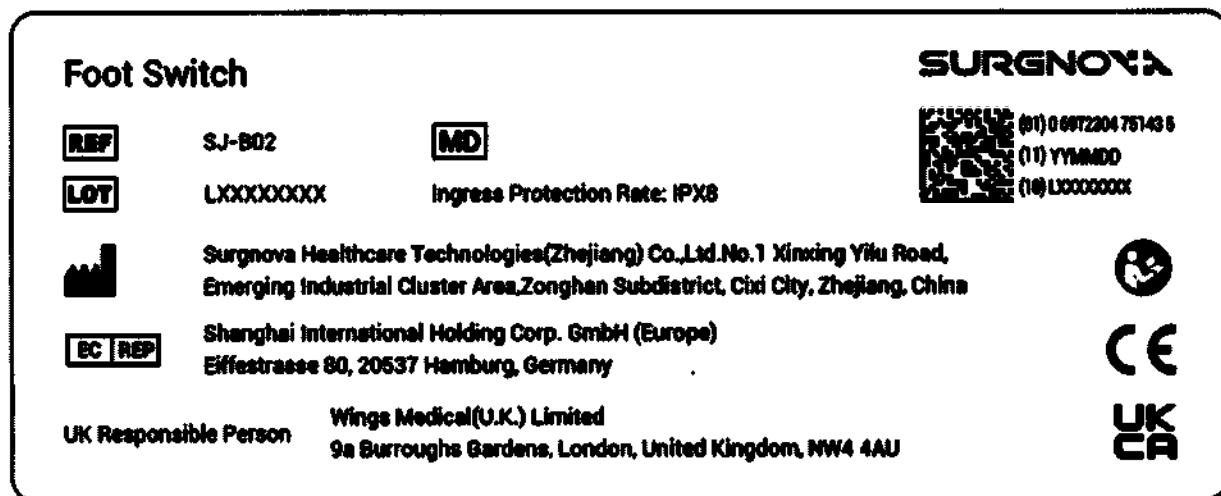

Макет стикера для педали:

Система микроволновой абляции Dorhi, в составе: Педаль ножная	
Производитель:	Сургнова Хелскеа Текнолоджиз (Чжэцзян) Ко. Лтд. Surgnova Healthcare Technologies (Zhejiang) Co. Ltd. No.1 Xinxing Yilu Road, Emerging Industrial Cluster Area, Zonghan Subdistrict, Cixi city, Zhejiang, 315301, China
Представитель производителя в РФ:	Общество с Ограниченной Ответственностью «Здоровье» 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, пом./ком. IV/9,10
Регистрационное Удостоверение № _____ от _____	

Пронумеровано, прошито

скреплено печатью на 15



Листа