

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Носова Т.А.

«*Юсентед*» 2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Анализатор гликированного гемоглобина (HPLC)

производства Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Рис.1 – Блок основной анализатора гликированного гемоглобина (HPLC), вариант исполнения GH-900Plus (вид спереди)



Рис.2 – Блок основной анализатора гликированного гемоглобина (HPLC), вариант исполнения GH-900Plus (вид сзади)

Lifotronic

Production name: Glycated hemoglobin analyzer (HPLC)


Model: GH-900Plus

Power: a.c.200V-240V, 50/60Hz, 120VA



Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.

Unit A, 4th Floor, Building15,Yijing Estate,No.1008 Songbai Road,Nanshan District,Shenzhen City,Guangdong Province,518055,P.R.China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



SN



102F22800001



2022-08



Рис.4– Блок основной анализатора гликированного гемоглобина (HPLC), вариант исполнения H8
(вид спереди)

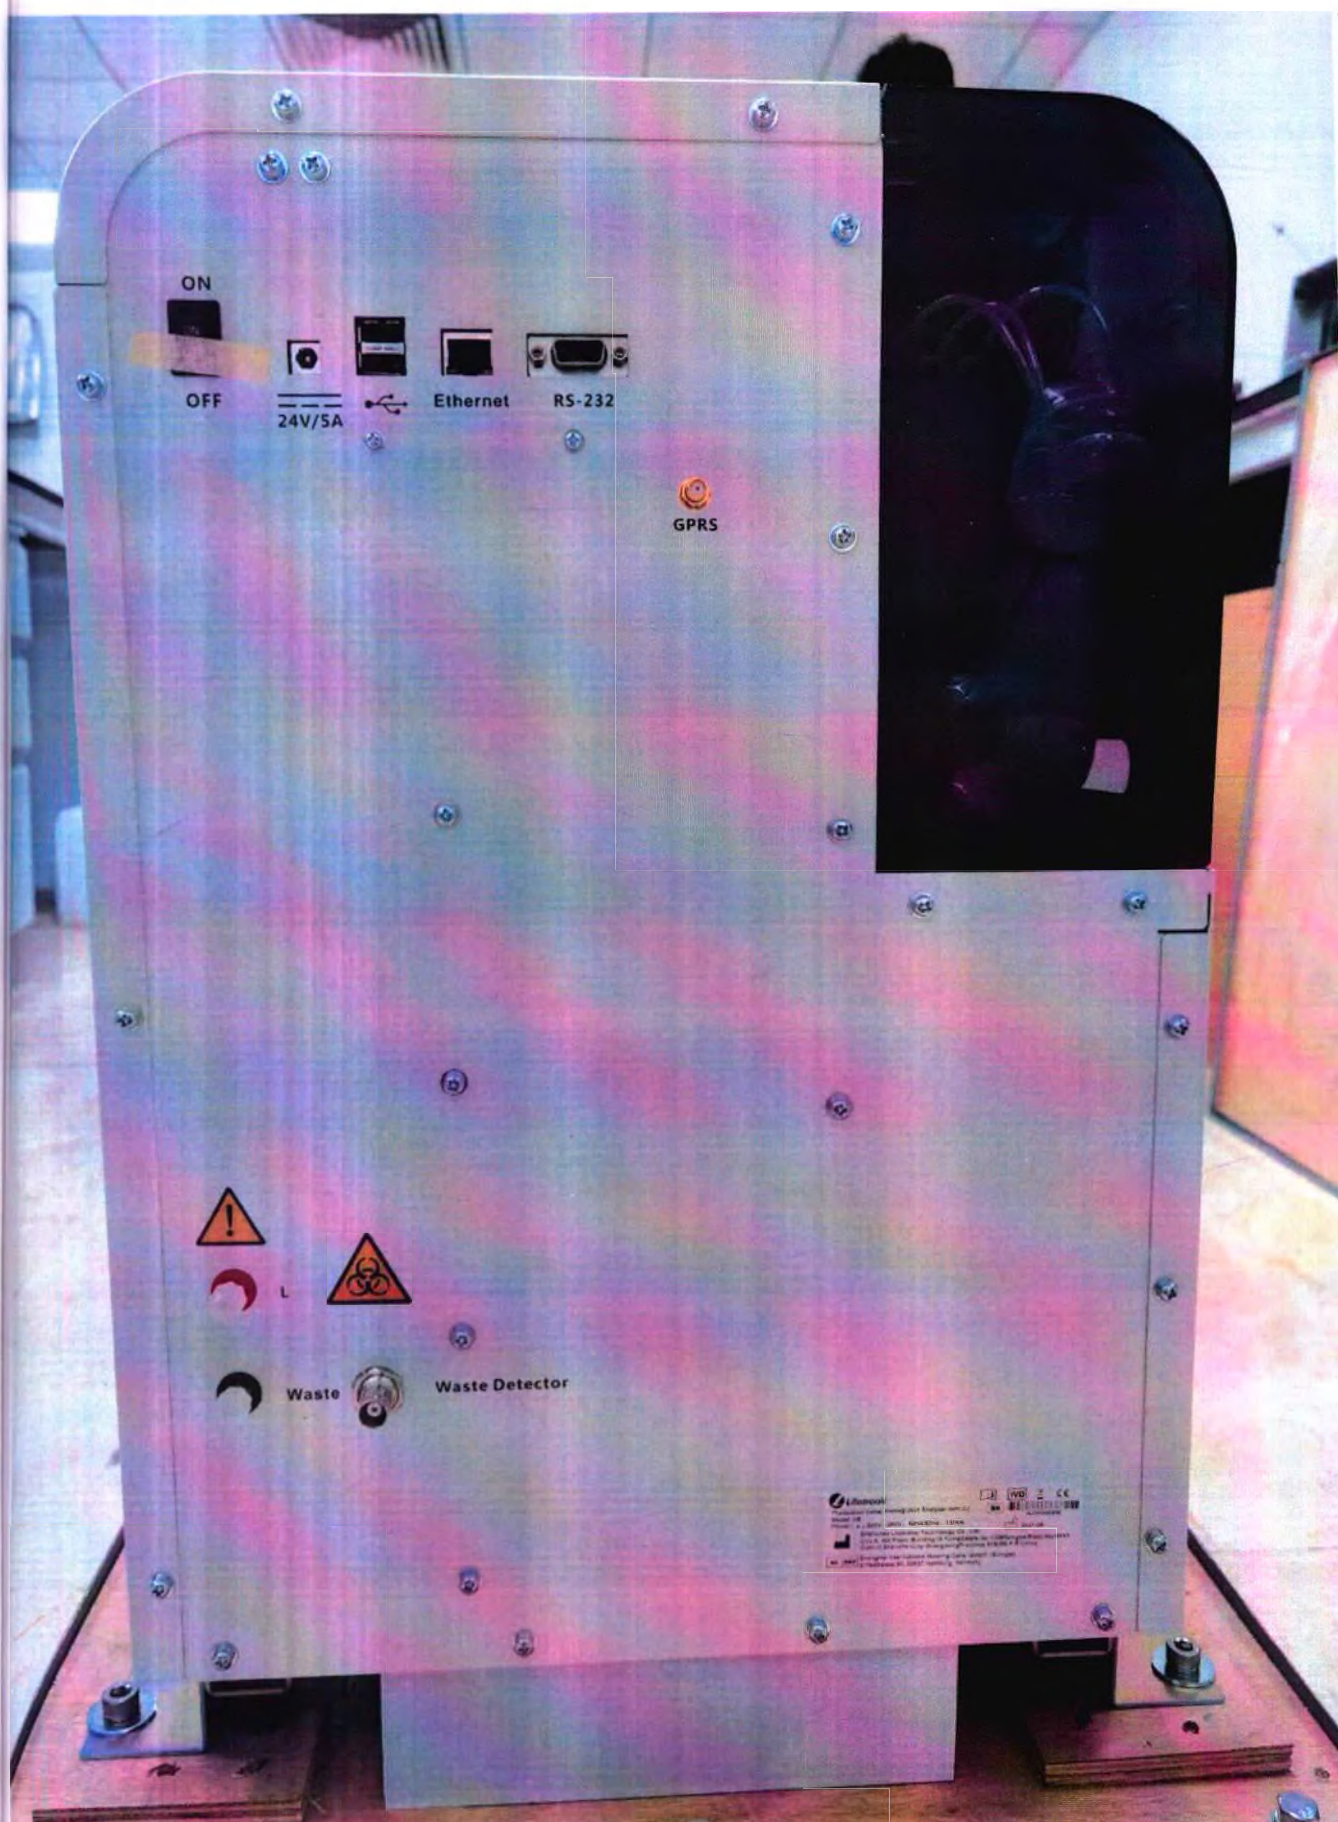


Рис.5 – Блок основной анализатора гликированного гемоглобина (HPLC), вариант исполнения H8 (вид сзади)

Lifotronic



Production name: Glycated hemoglobin analyzer (HPLC)

Model: H8

SN



IA2D22800555

Power: a.c.200-240V, 50Hz/60Hz, 120VA




Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.



2022-08

Unit A, 4th Floor, Building15, Yijing Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518055, P.R.China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Рис.7 – Блок основной анализатора гликированного гемоглобина (HPLC), вариант исполнения H9 (вид спереди)



Рис.8 – Блок основной анализатора гликированного гемоглобина (HPLC), вариант исполнения Н9
(вид сзади)

Lifotronic



Production name: Glycated hemoglobin analyzer(HPLC)



IA2B22800400

Model: H9

Power: a.c.200V—240V, 50Hz/60Hz, 120VA




2022-08



Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.

Unit A, 4th Floor, Building15,Yijing Estate,No.1008 Songbai Road,Nanshan District,Shenzhen City,Guangdong Province,518055,P.R.China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

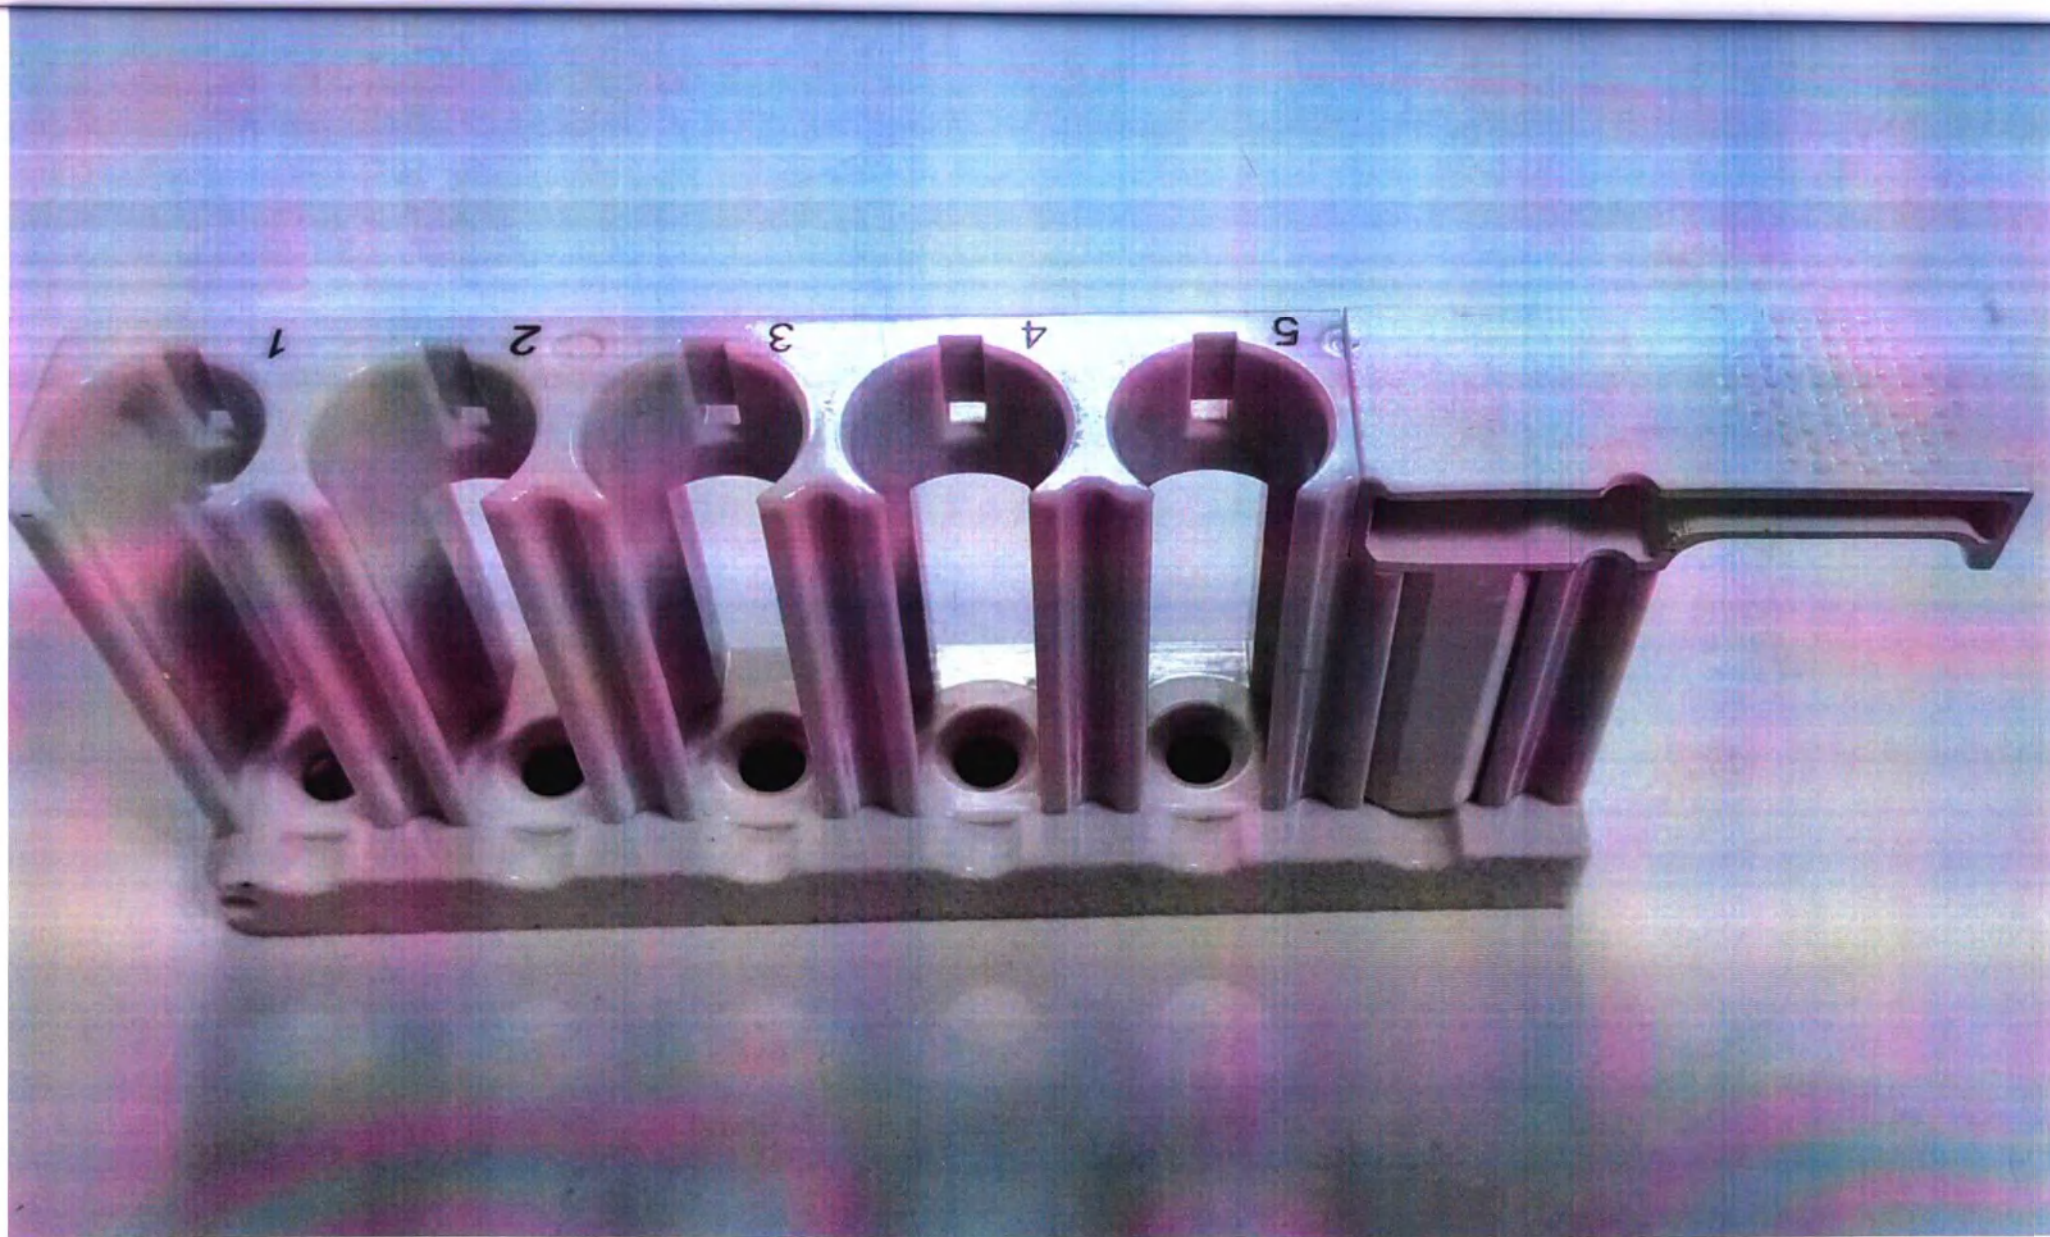


Рис 10. – Штатив для образцов для варианта исполнения GH-900Plus



Рис.11. – Штатив для образцов для вариантов исполнения Н8 и Н9

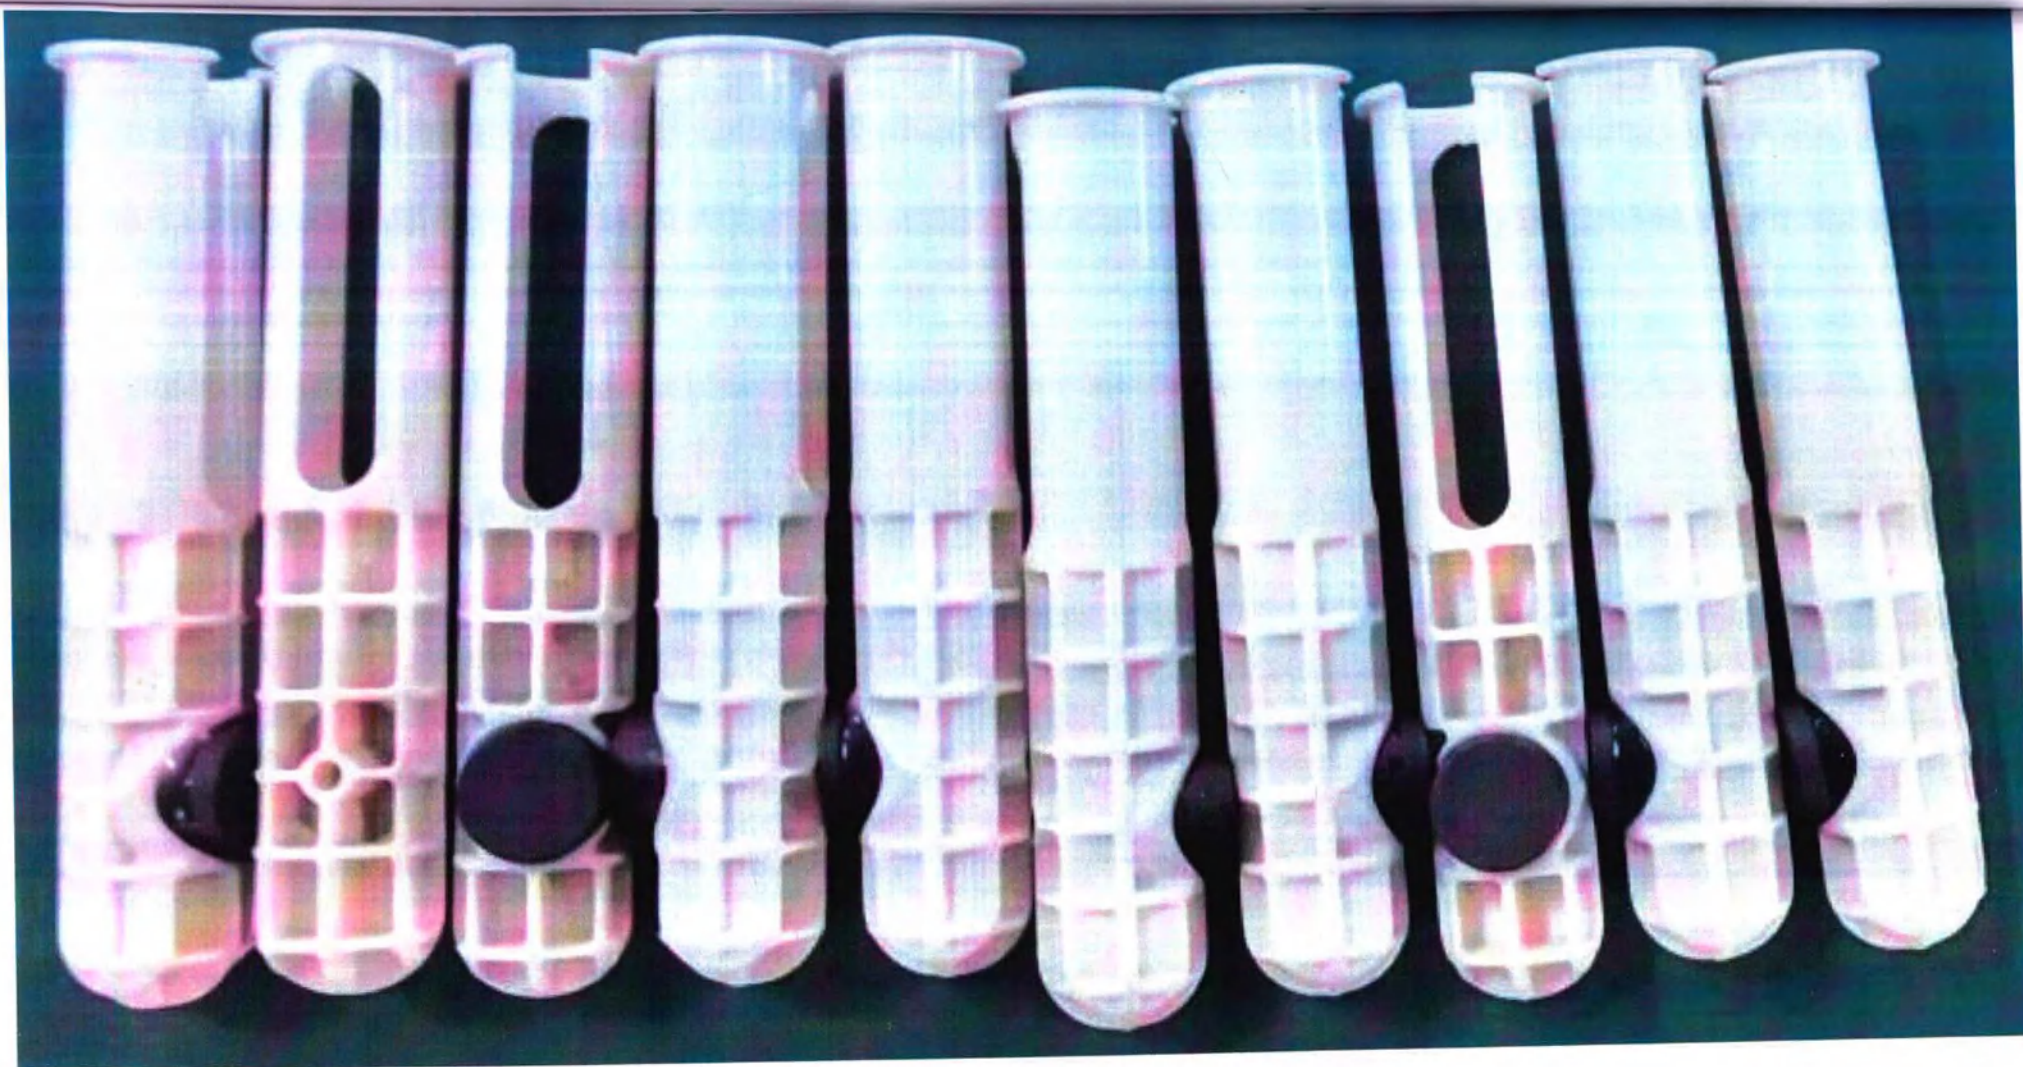


Рис.12. - Держатель образца для разбавления для вариантов исполнения GH-900Plus, H8, H9

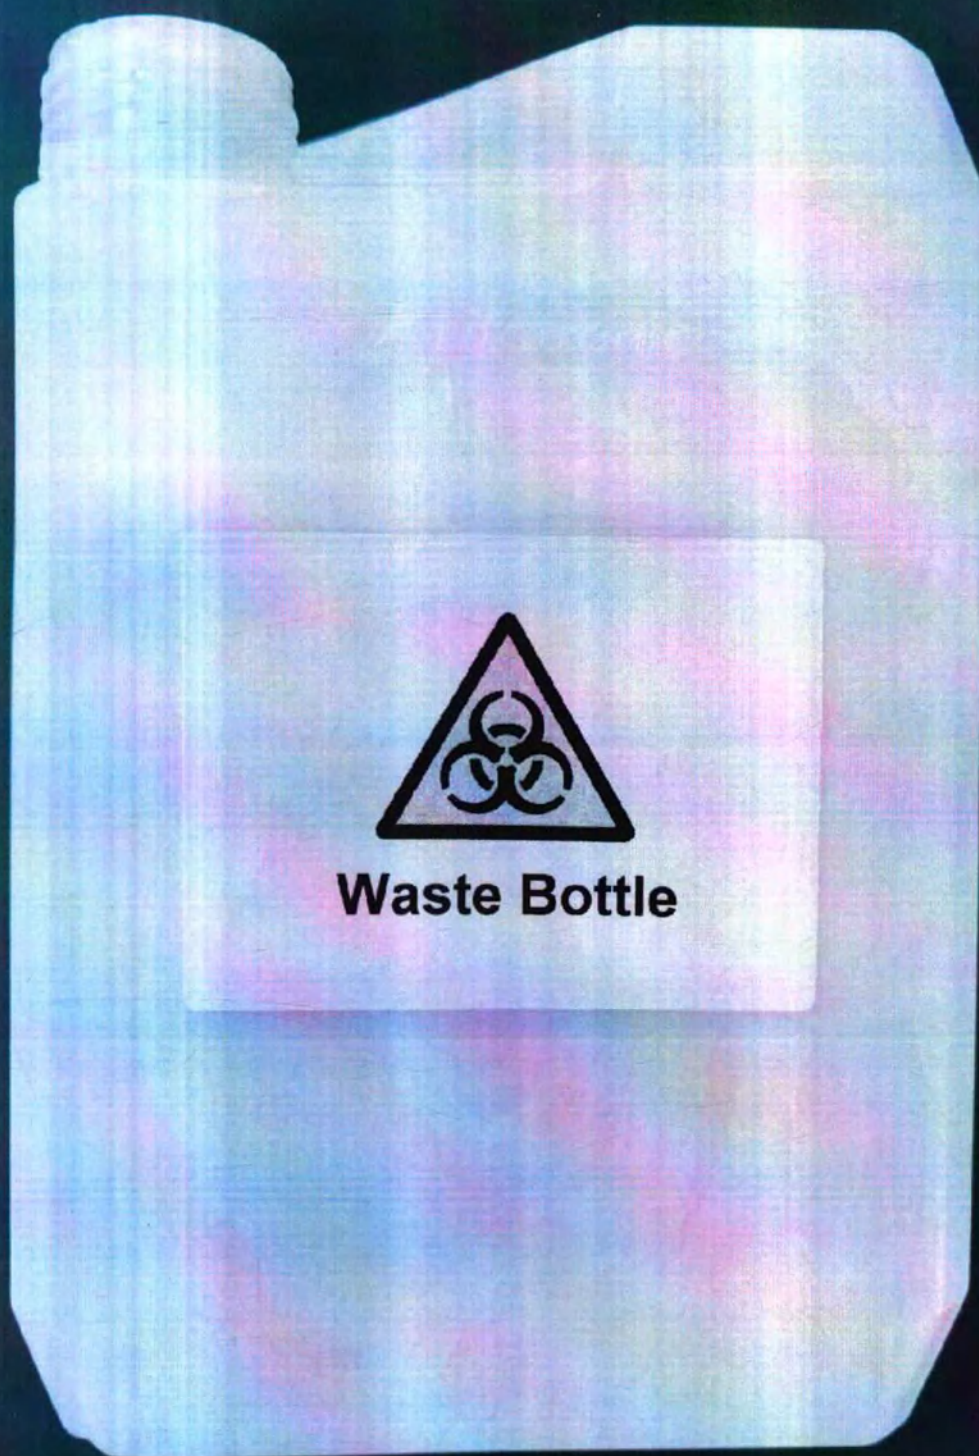


Рис.13 – Канистра для отходов 5л для вариантов исполнения GH-900Plus, H9



Рис.14 – Канистра для отходов 10л для варианта исполнения Н8

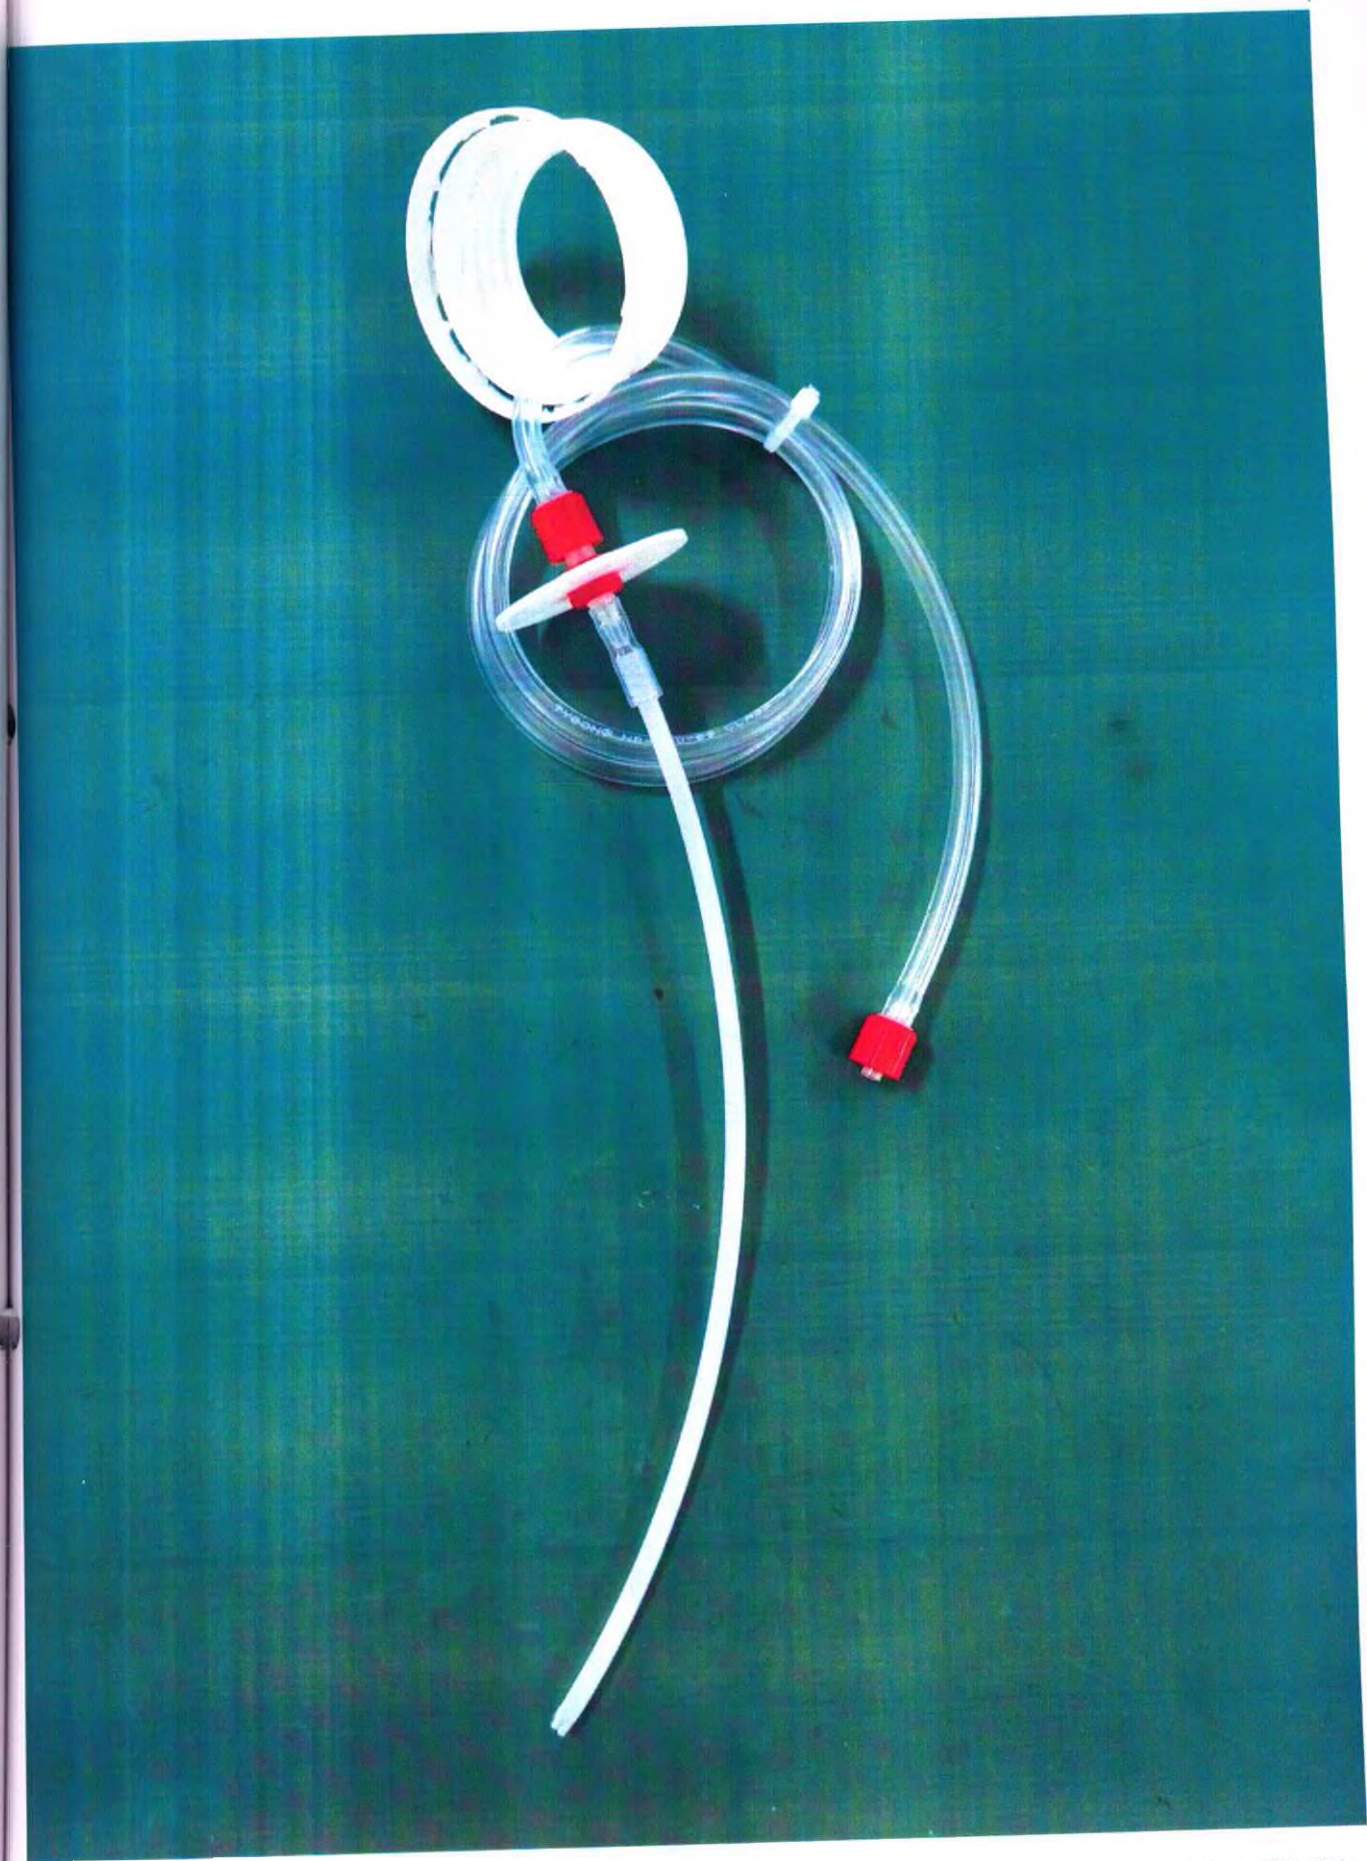


Рис.15 - Соединительная трубка для реагента L для вариантов исполнения GH-900Plus, H8, H9

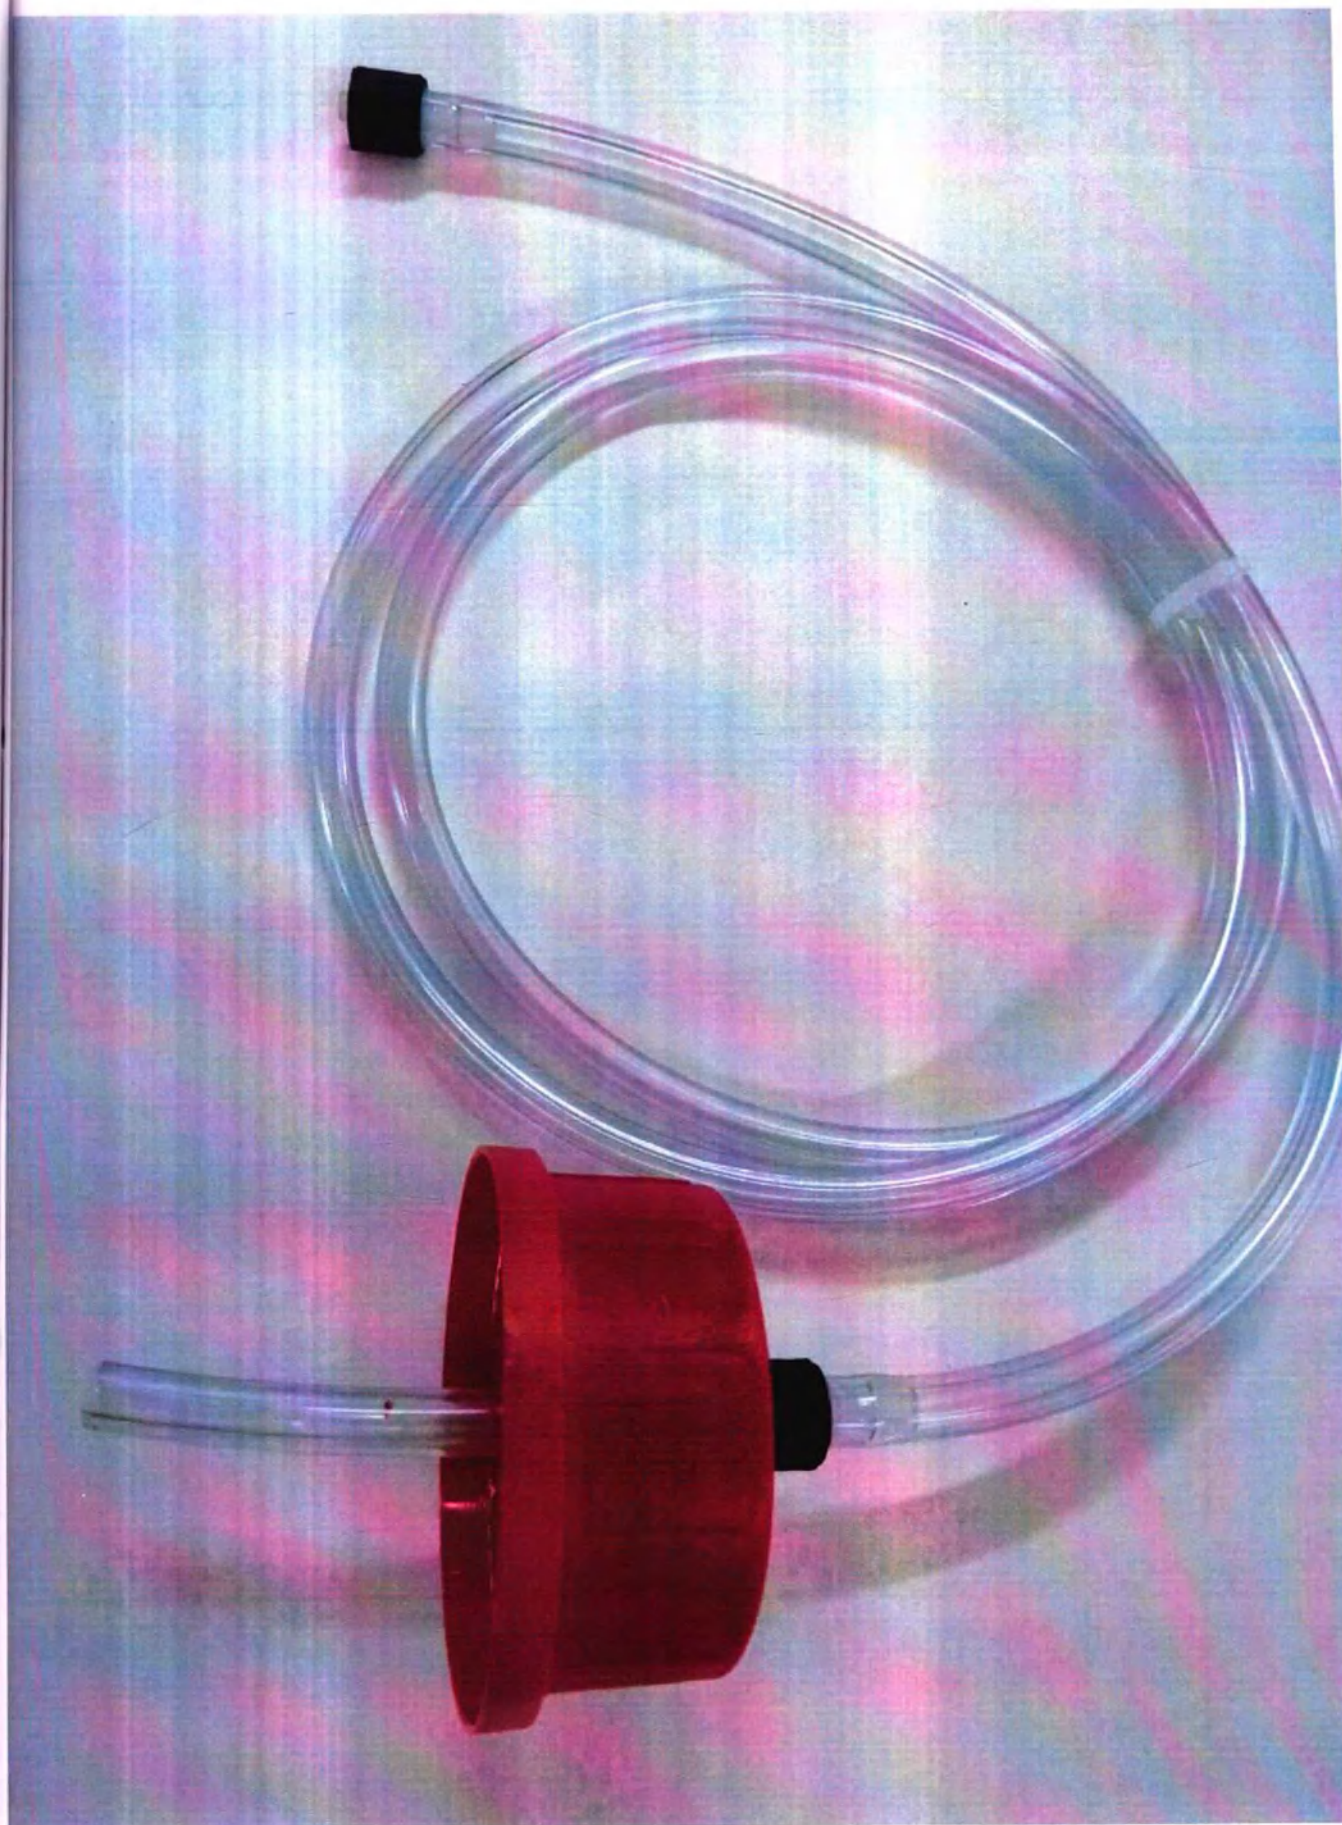


Рис.16 - Соединительная трубка для отходов для вариантов исполнения GH-900Plus, H9



Рис.17 - Соединительная трубка для отходов с датчиком для варианта исполнения Н8

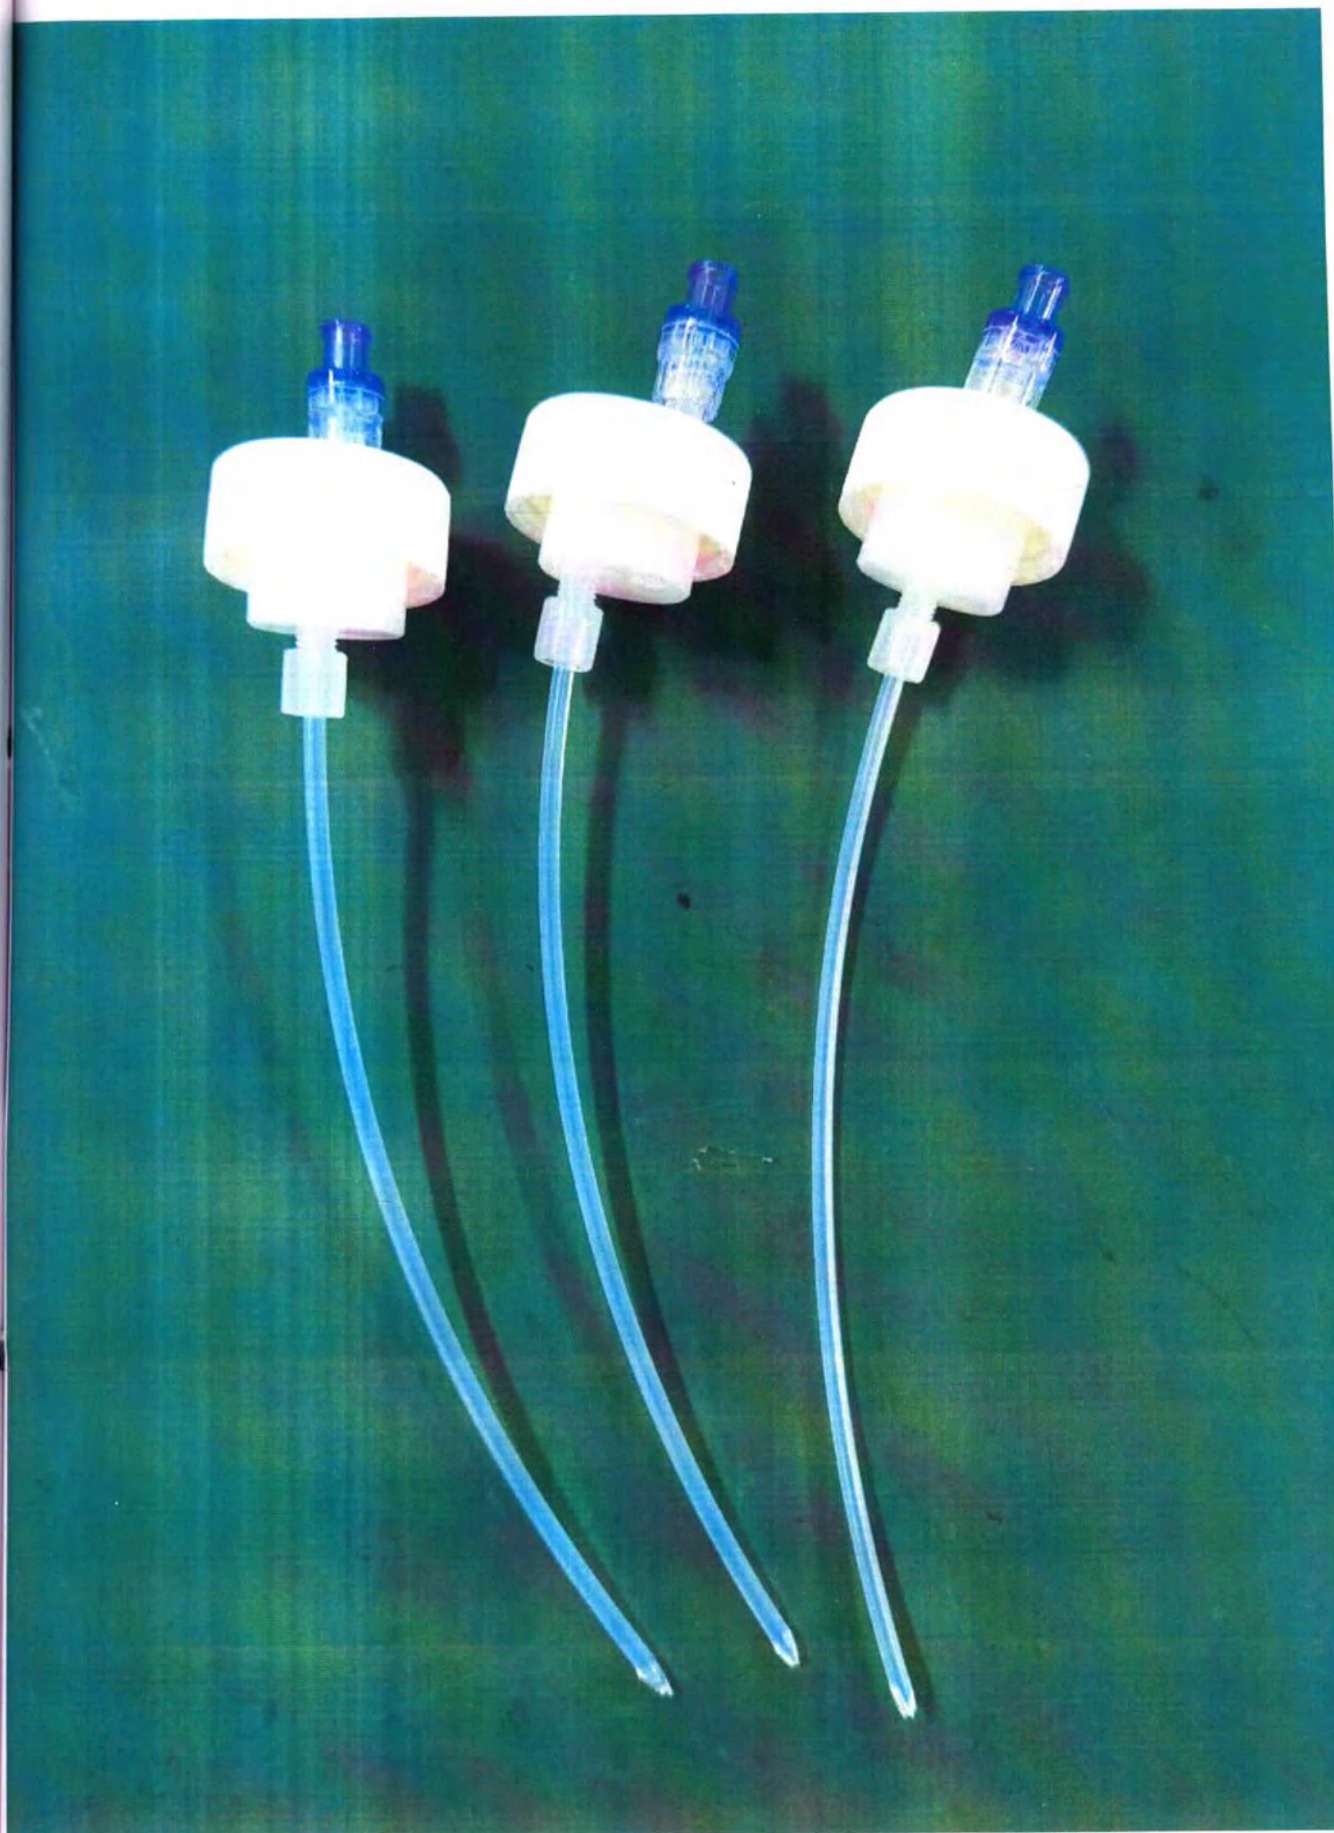


Рис.18 - Соединительная трубка для реагентов ABC для варианта исполнения Н8

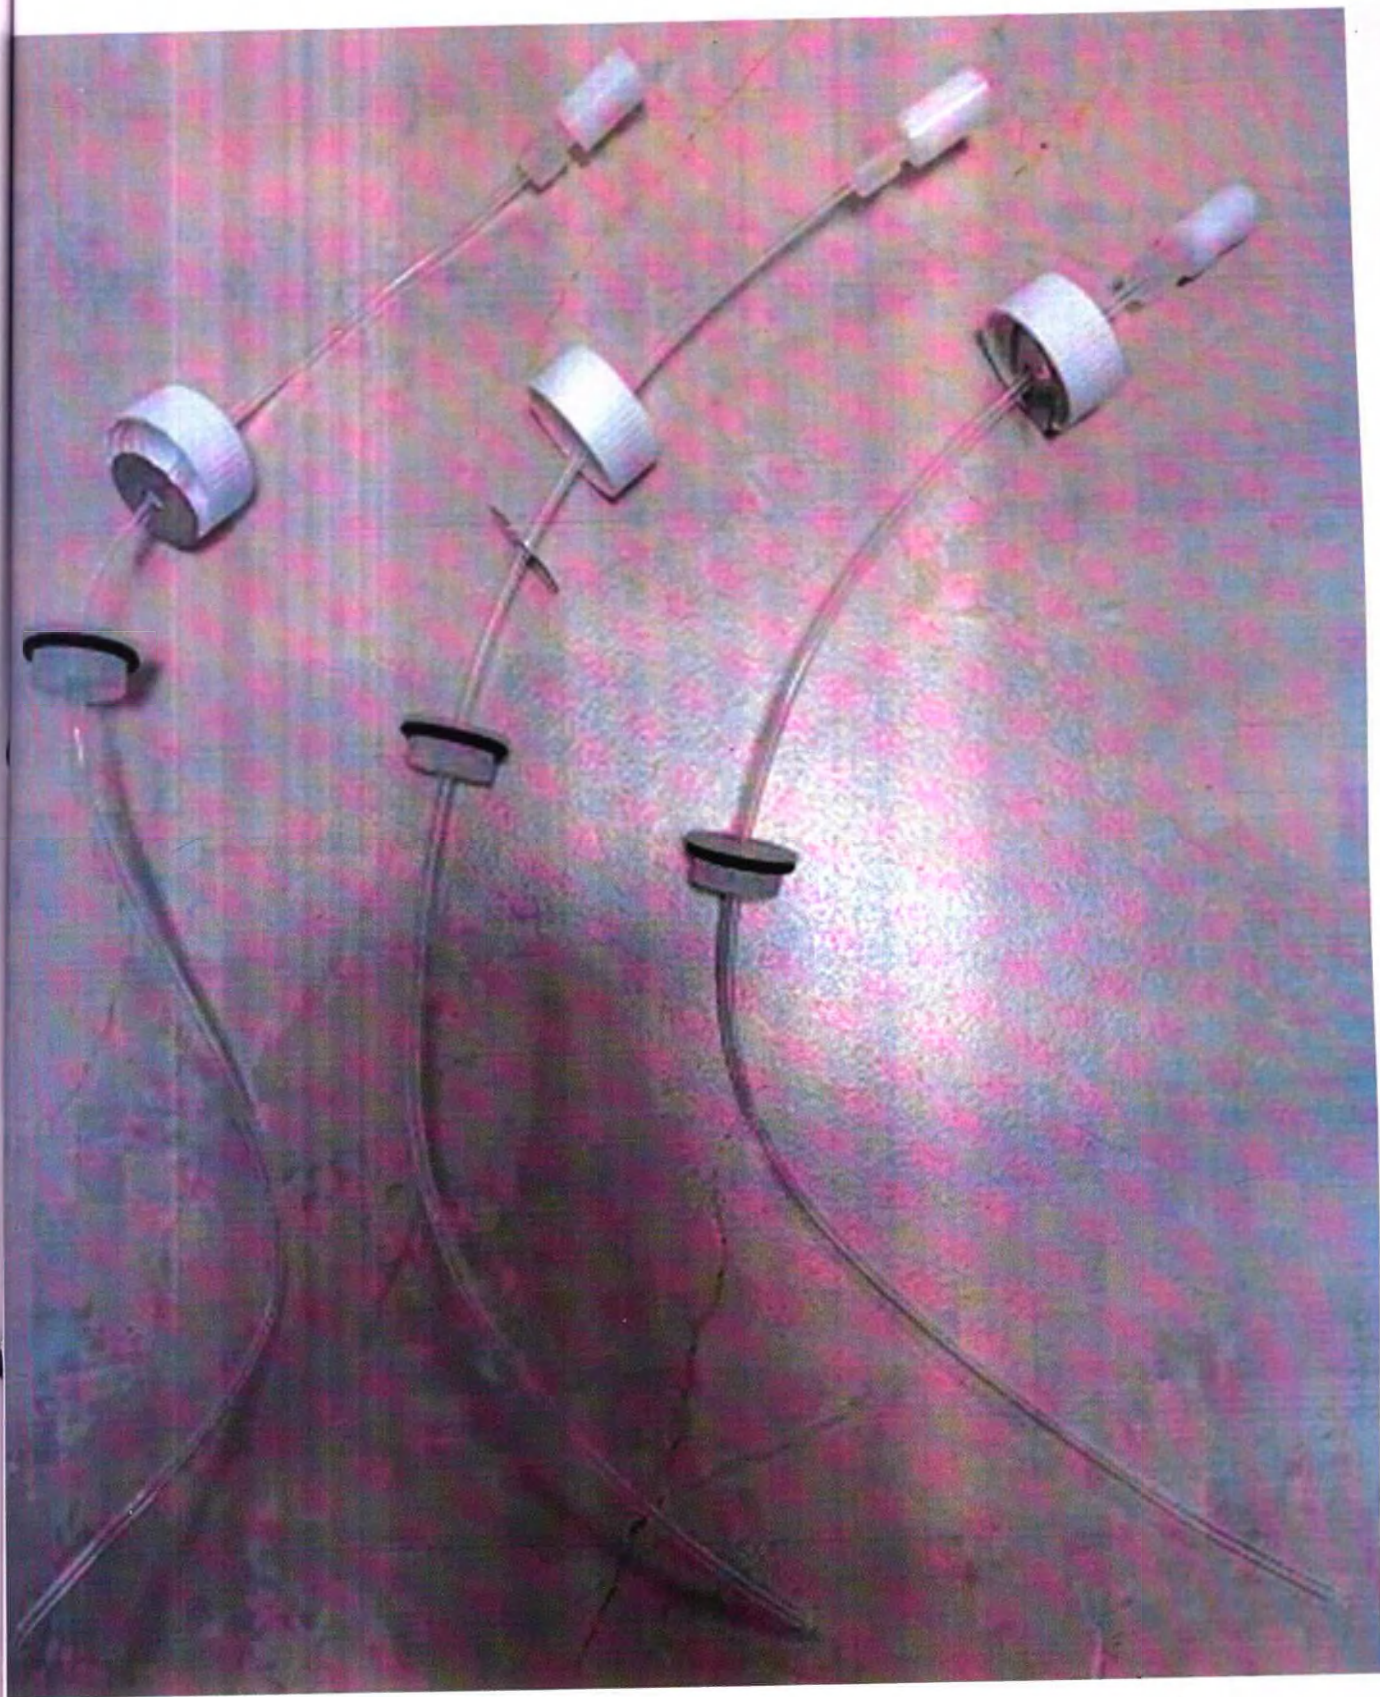


Рис.19 - Соединительная трубка для реагентов АВС для варианта исполнения Н9



Рис.20. – Кабель питания для вариантов исполнения GH-900Plus, H8, H9



Рис.21. – Адаптер питания для вариантов исполнения GH-900Plus, H8, H9



Рис.22. – Сканер штрих-кода для вариантов исполнения GH-900Plus, H8

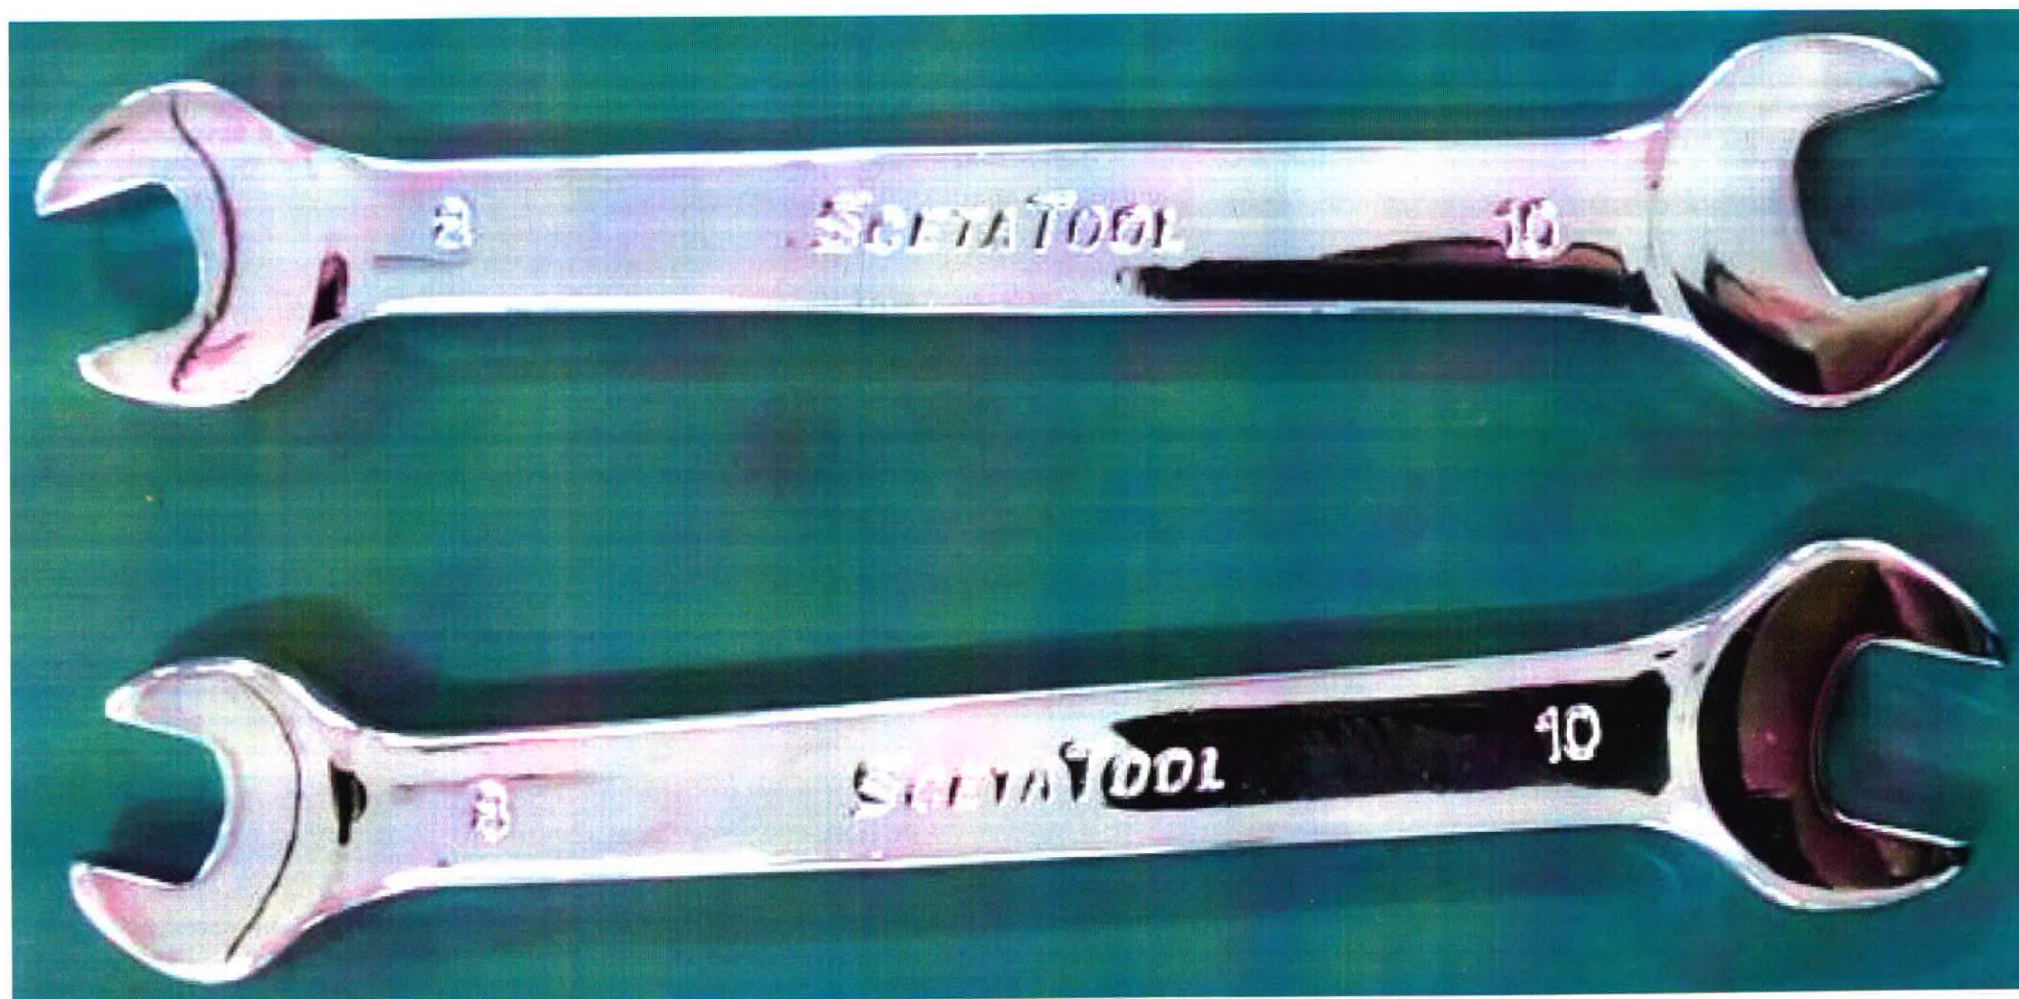


Рис.23 – Гаечный ключ для вариантов исполнения GH-900Plus, Н8, Н9

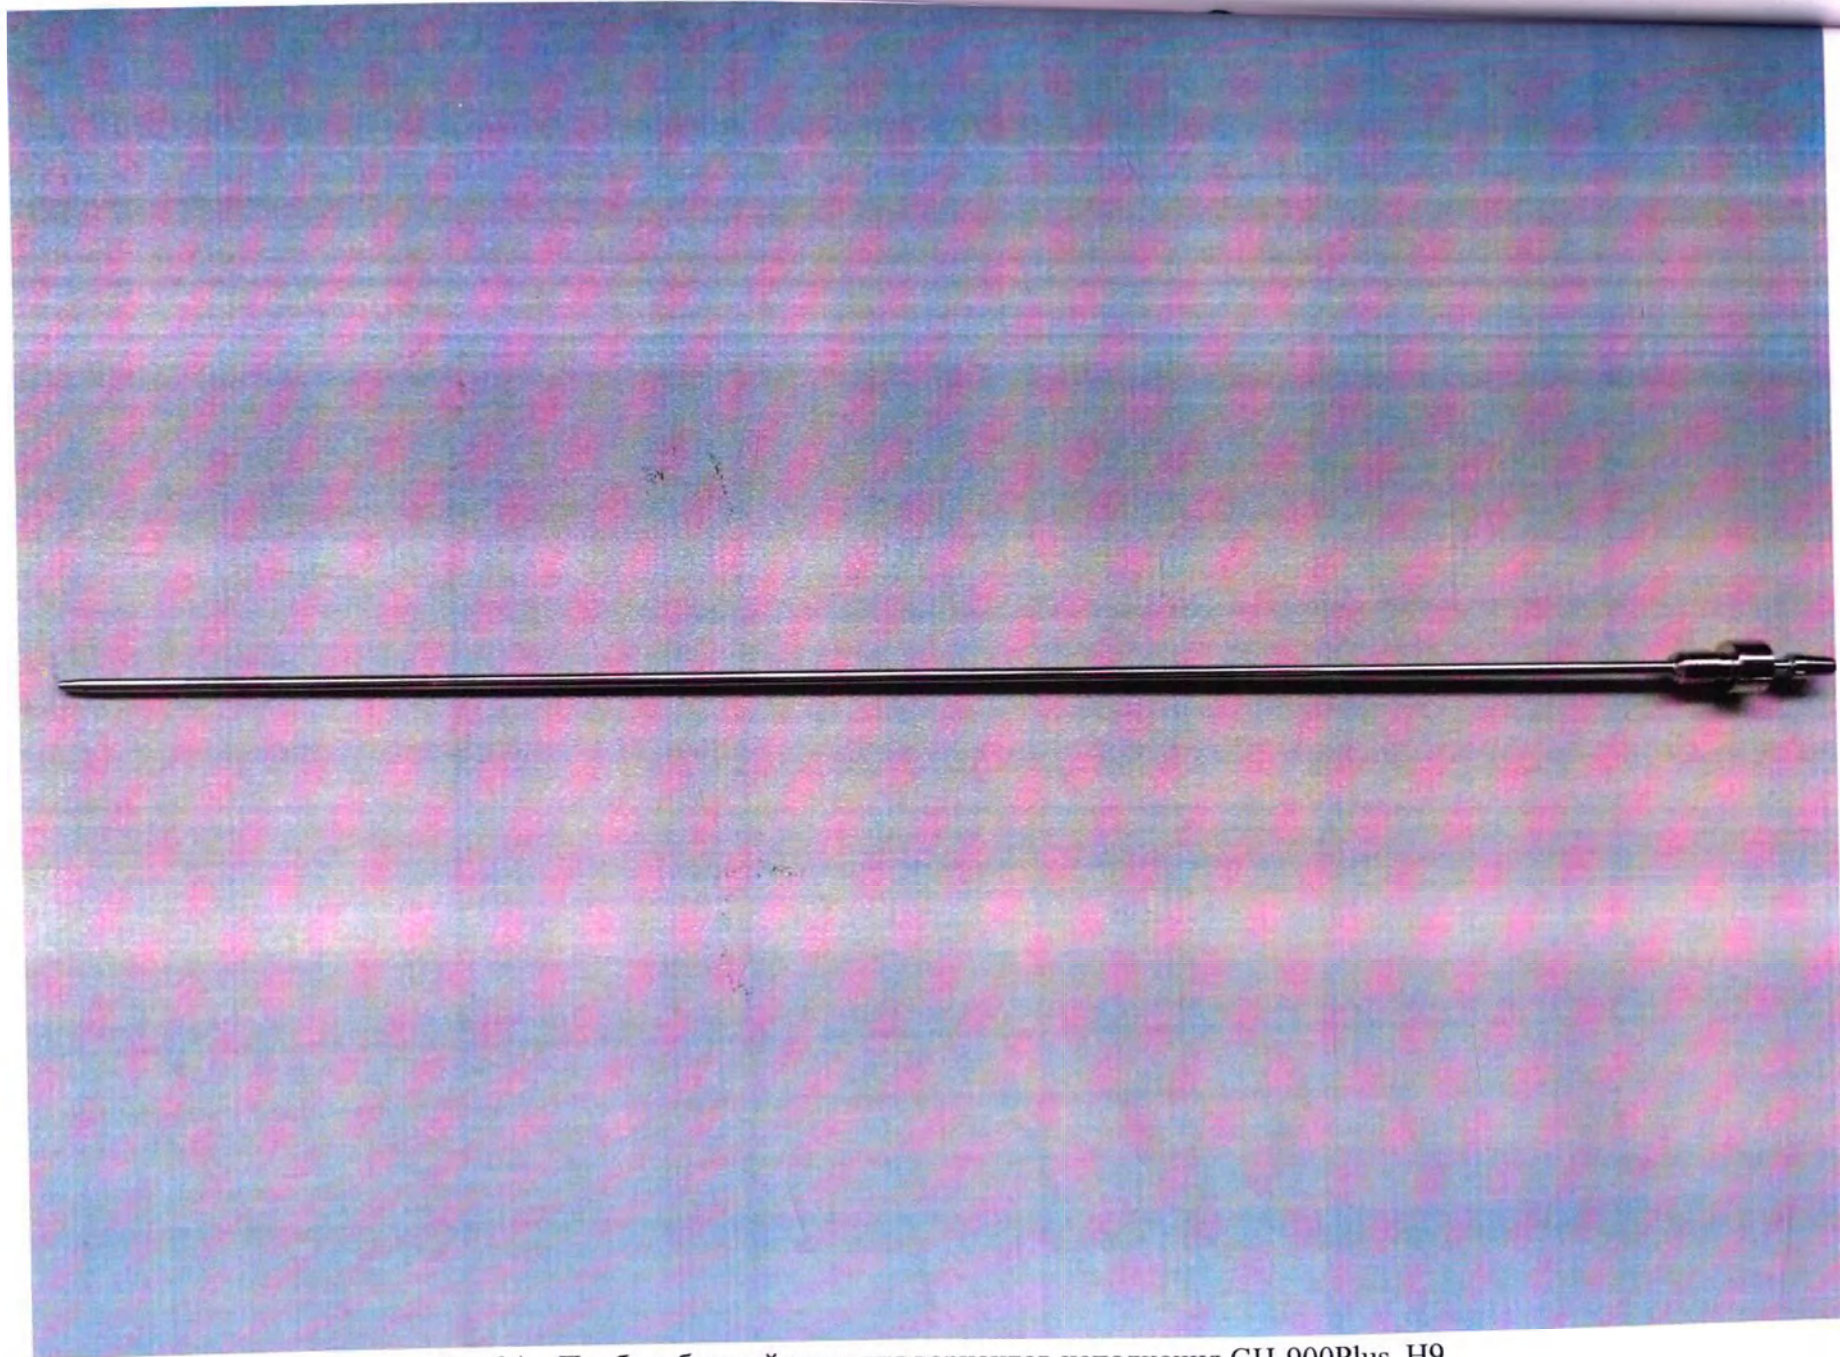


Рис.24 – Пробоотборный зонд для вариантов исполнения GH-900Plus, H9

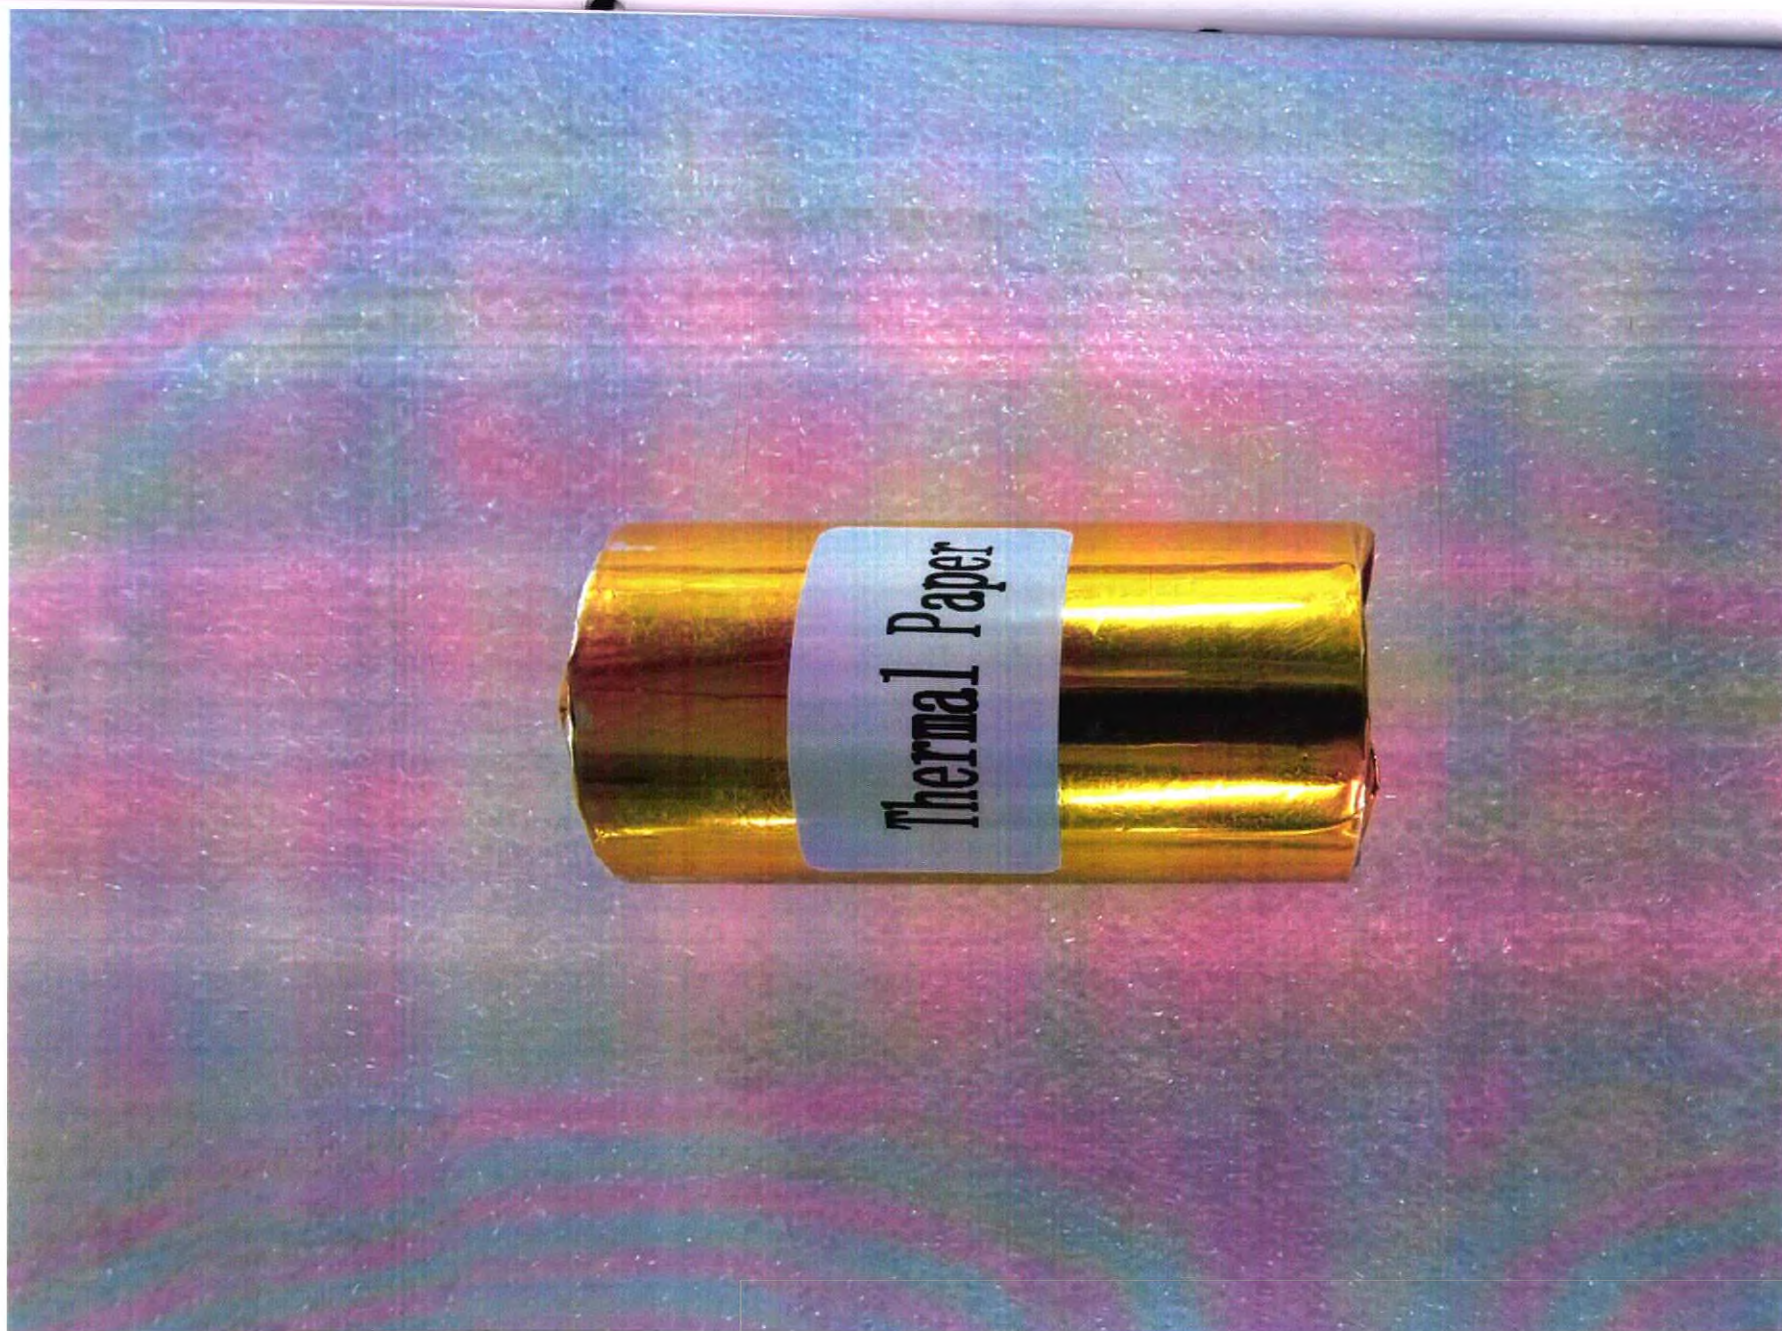


Рис. 25. - Термобумага для вариантов исполнения GH-900Plus, H8, H9

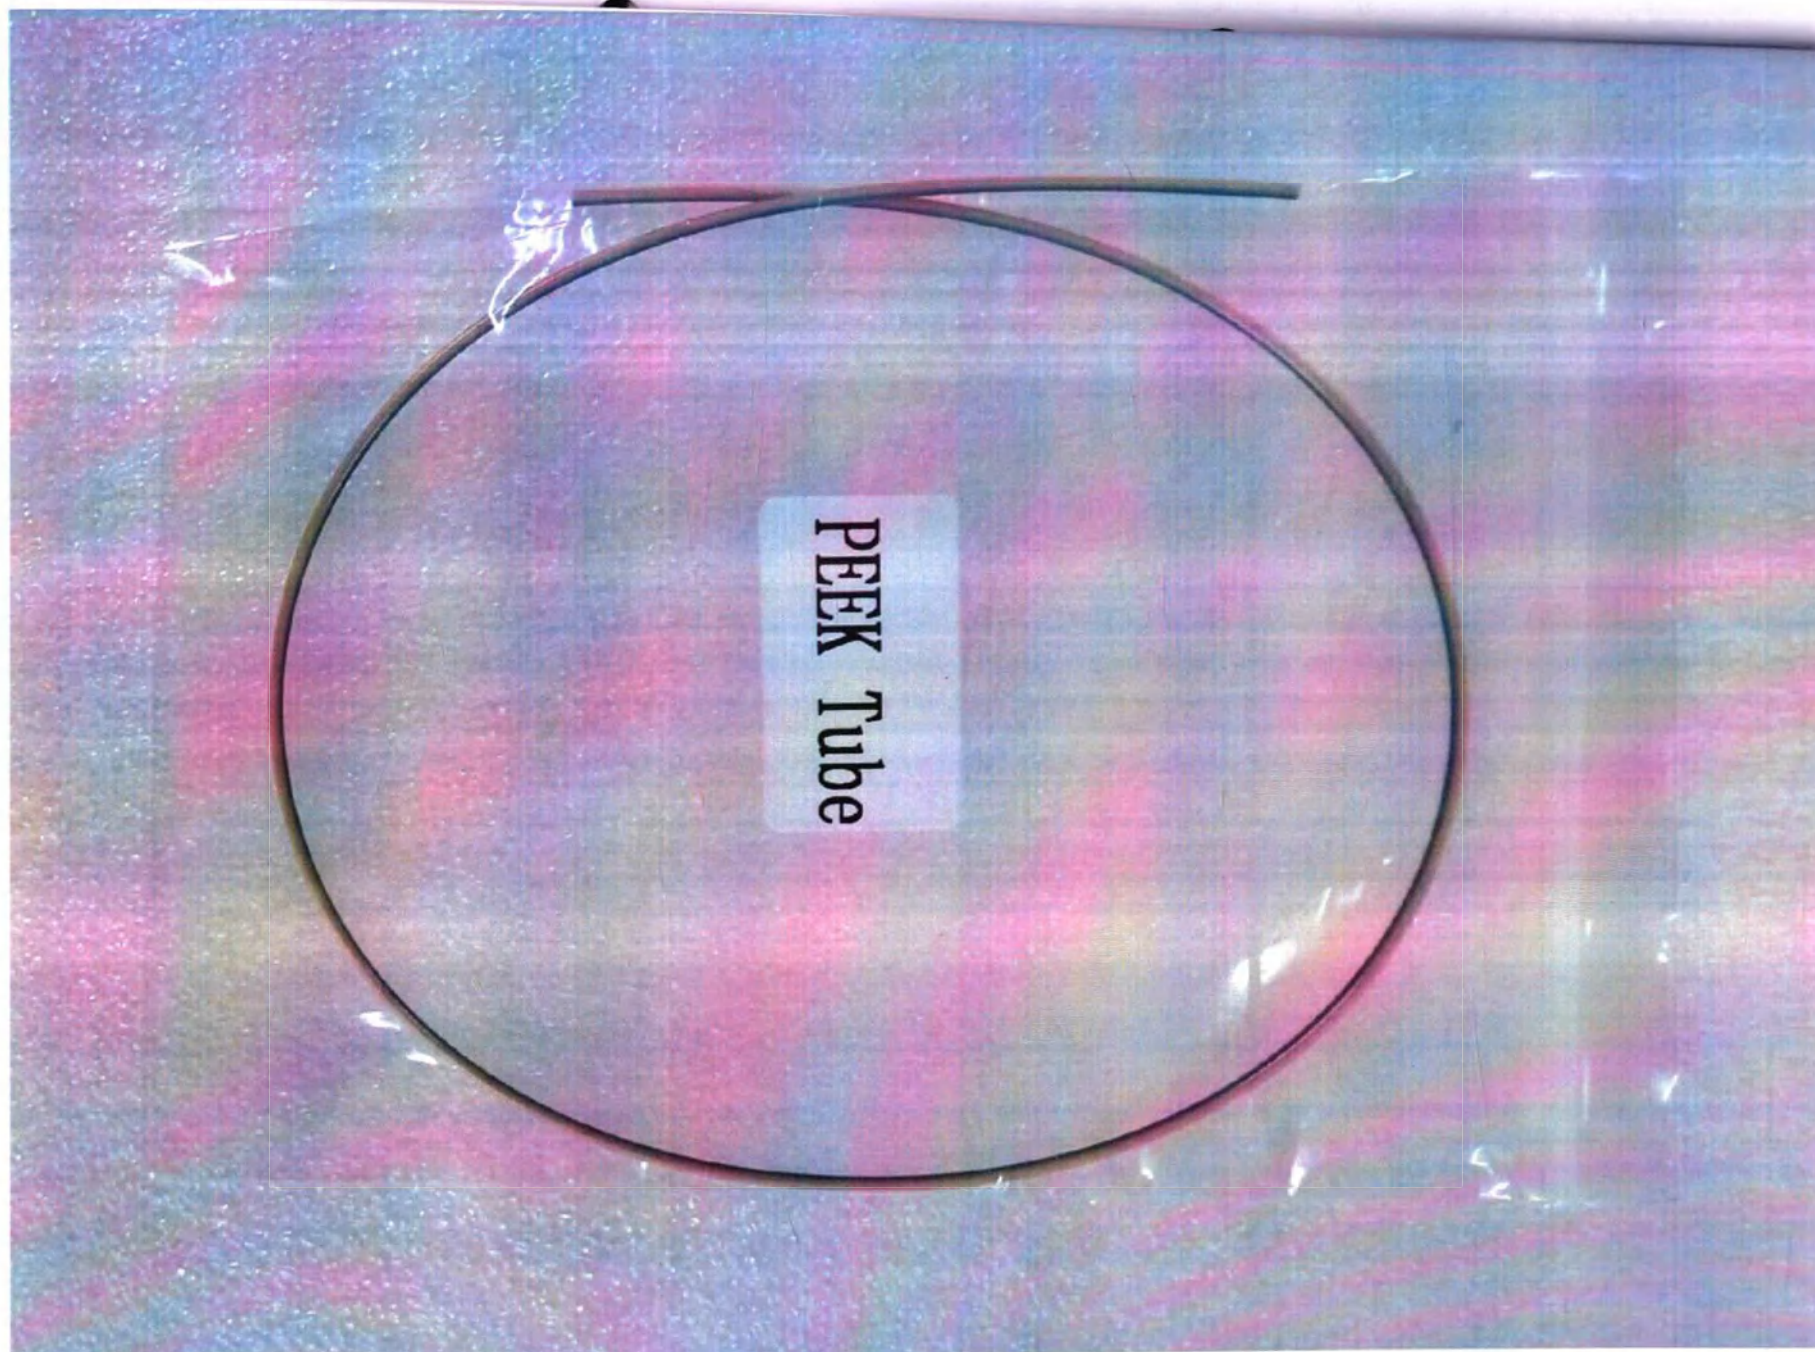
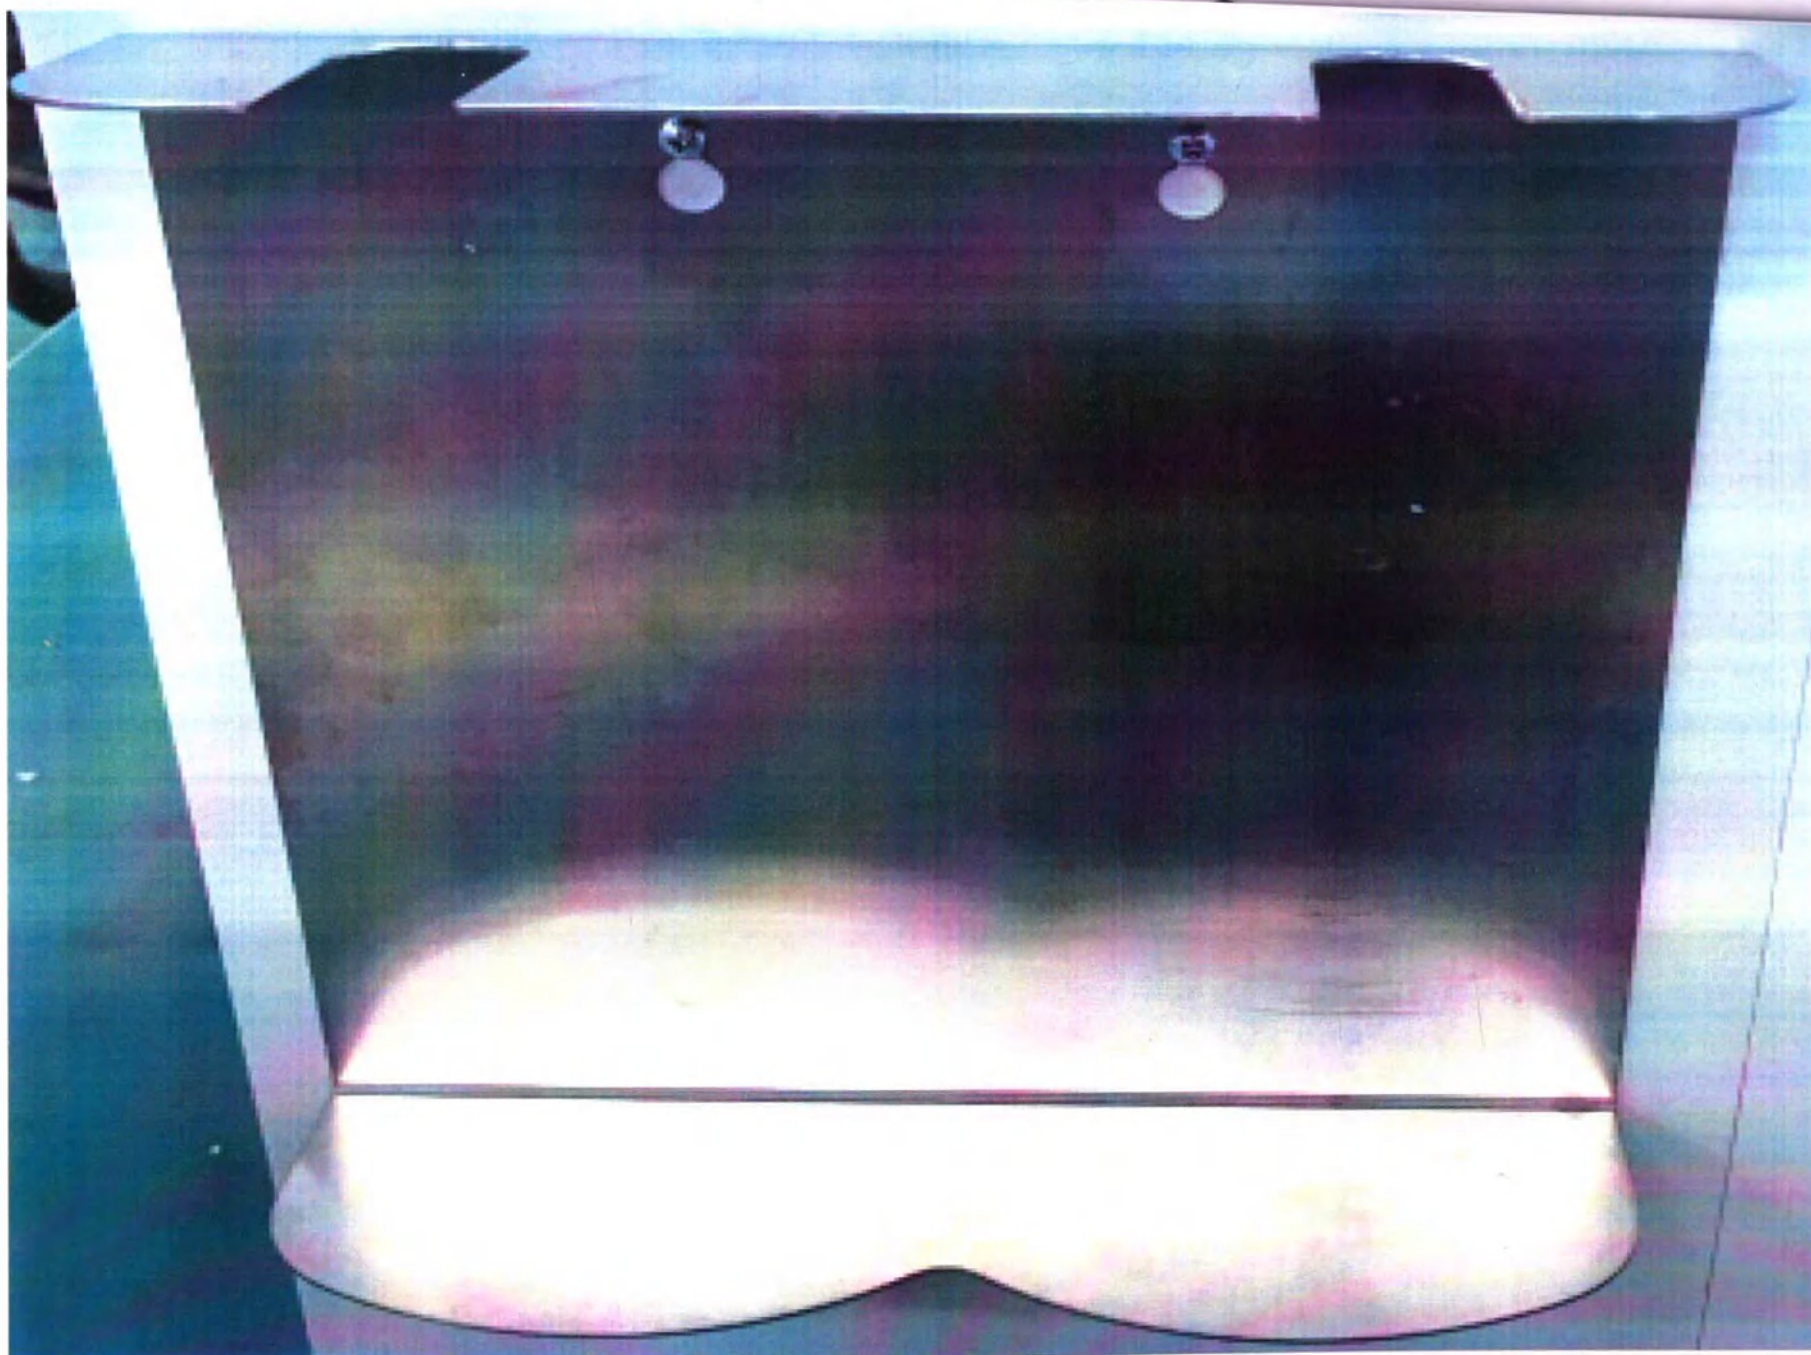


Рис. 26. Трубка РЕЕК для вариантов исполнения Н8, Н9



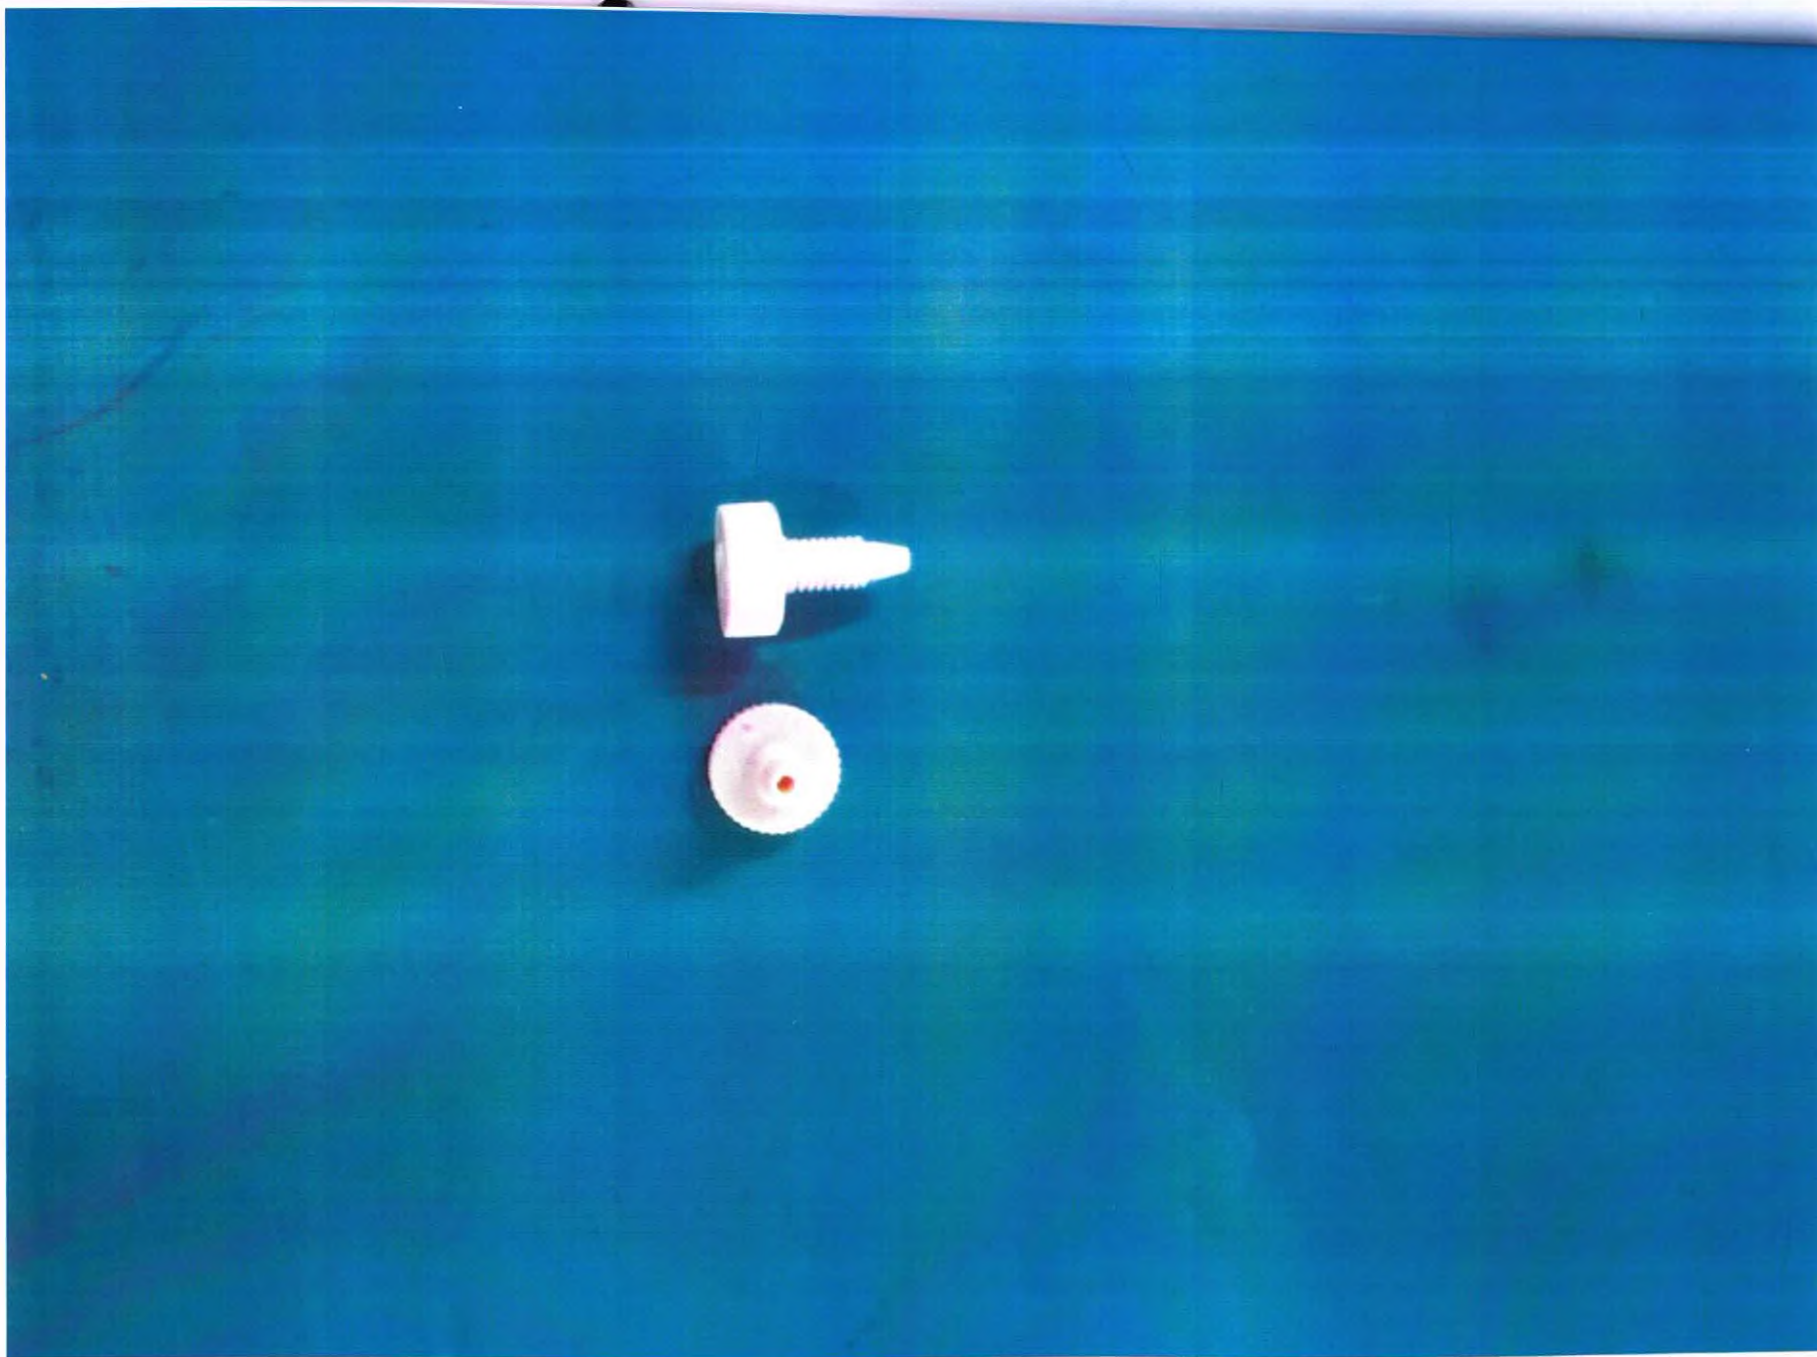


Рис. 28. Ручной соединитель для вариантов исполнения Н8, Н9

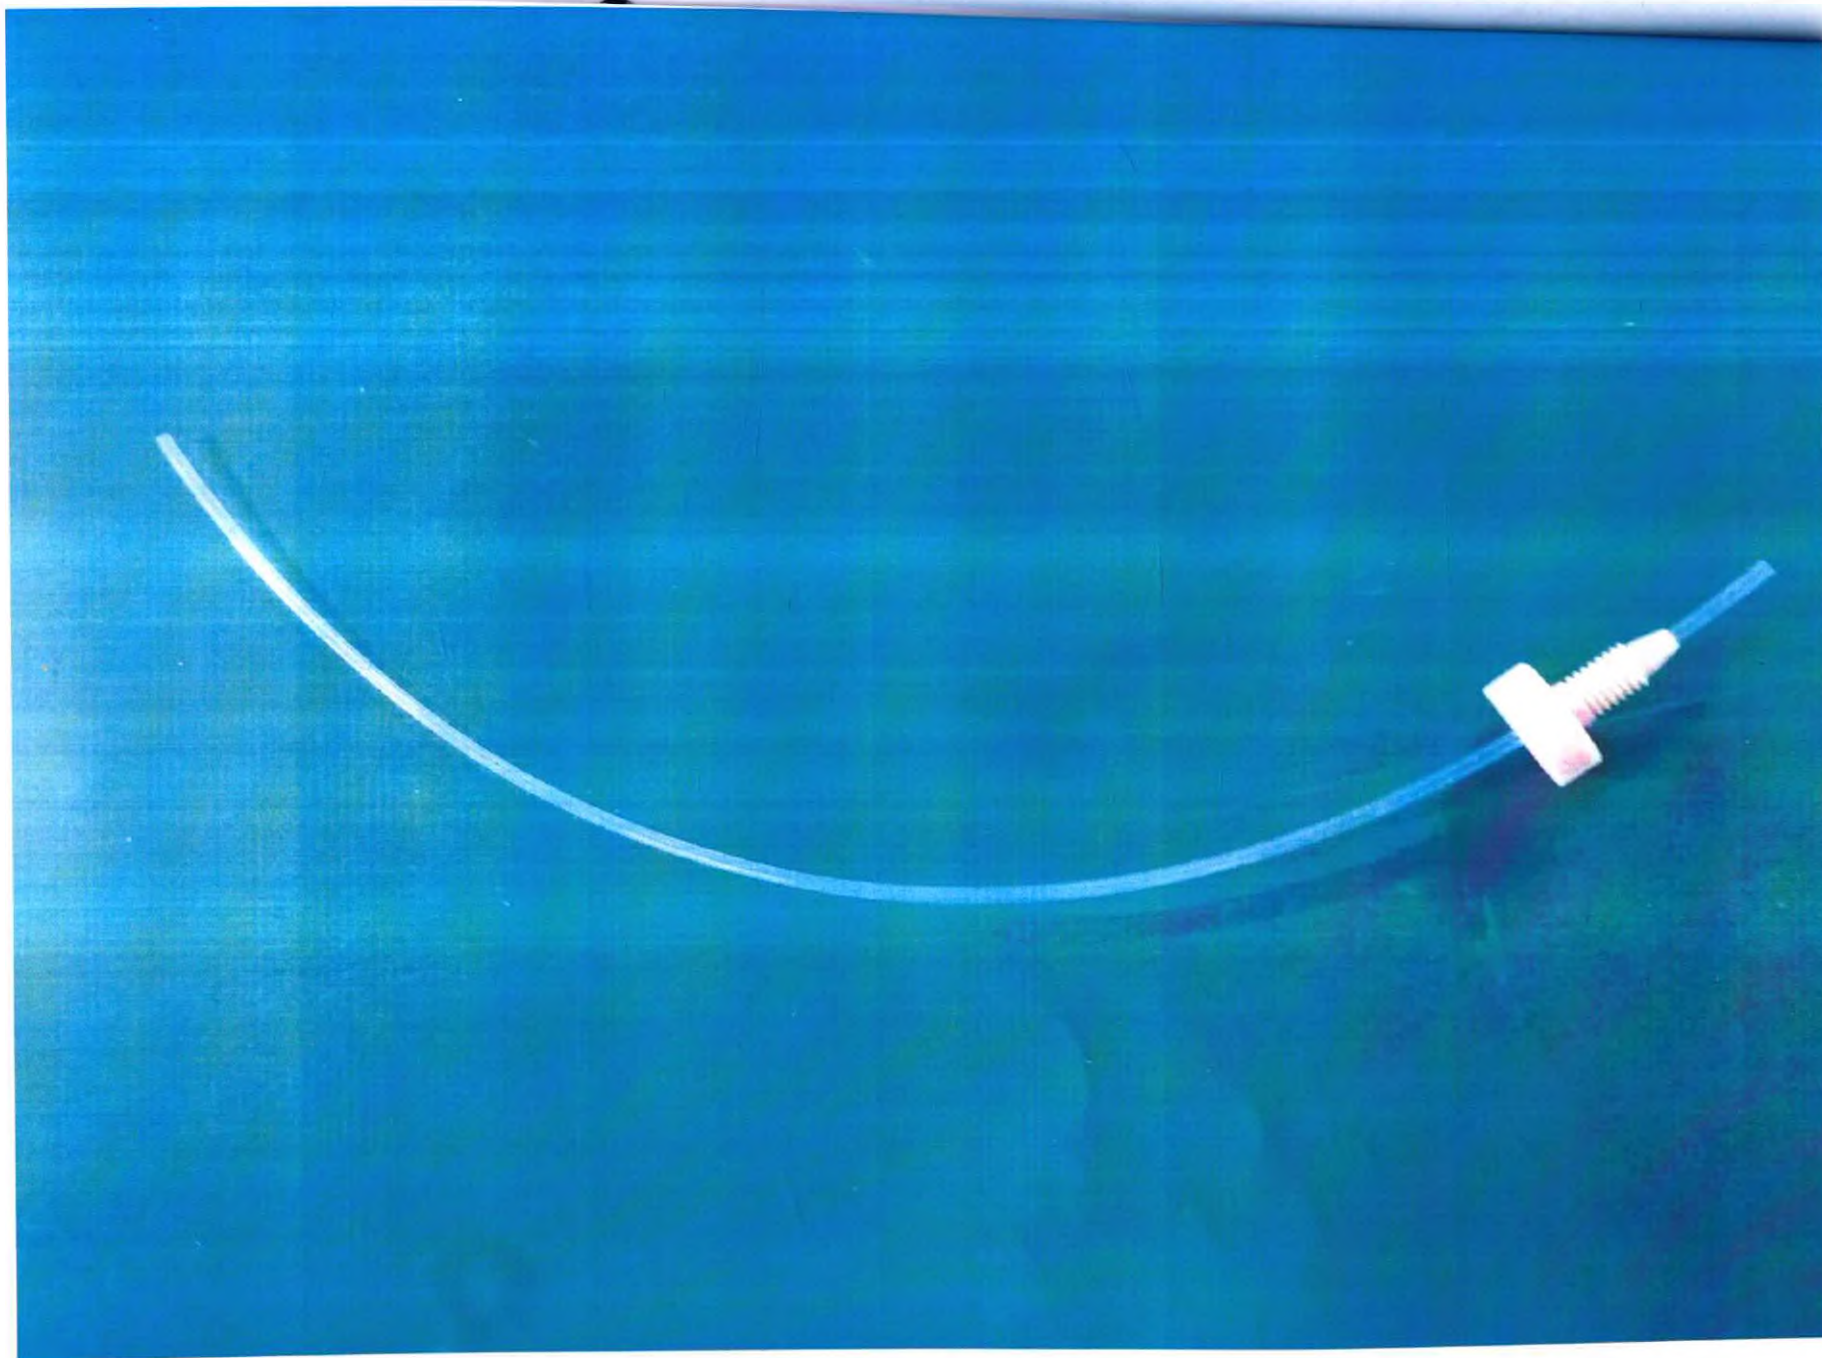


Рис. 29. Выпускная жидкостная трубка для варианта исполнения Н9

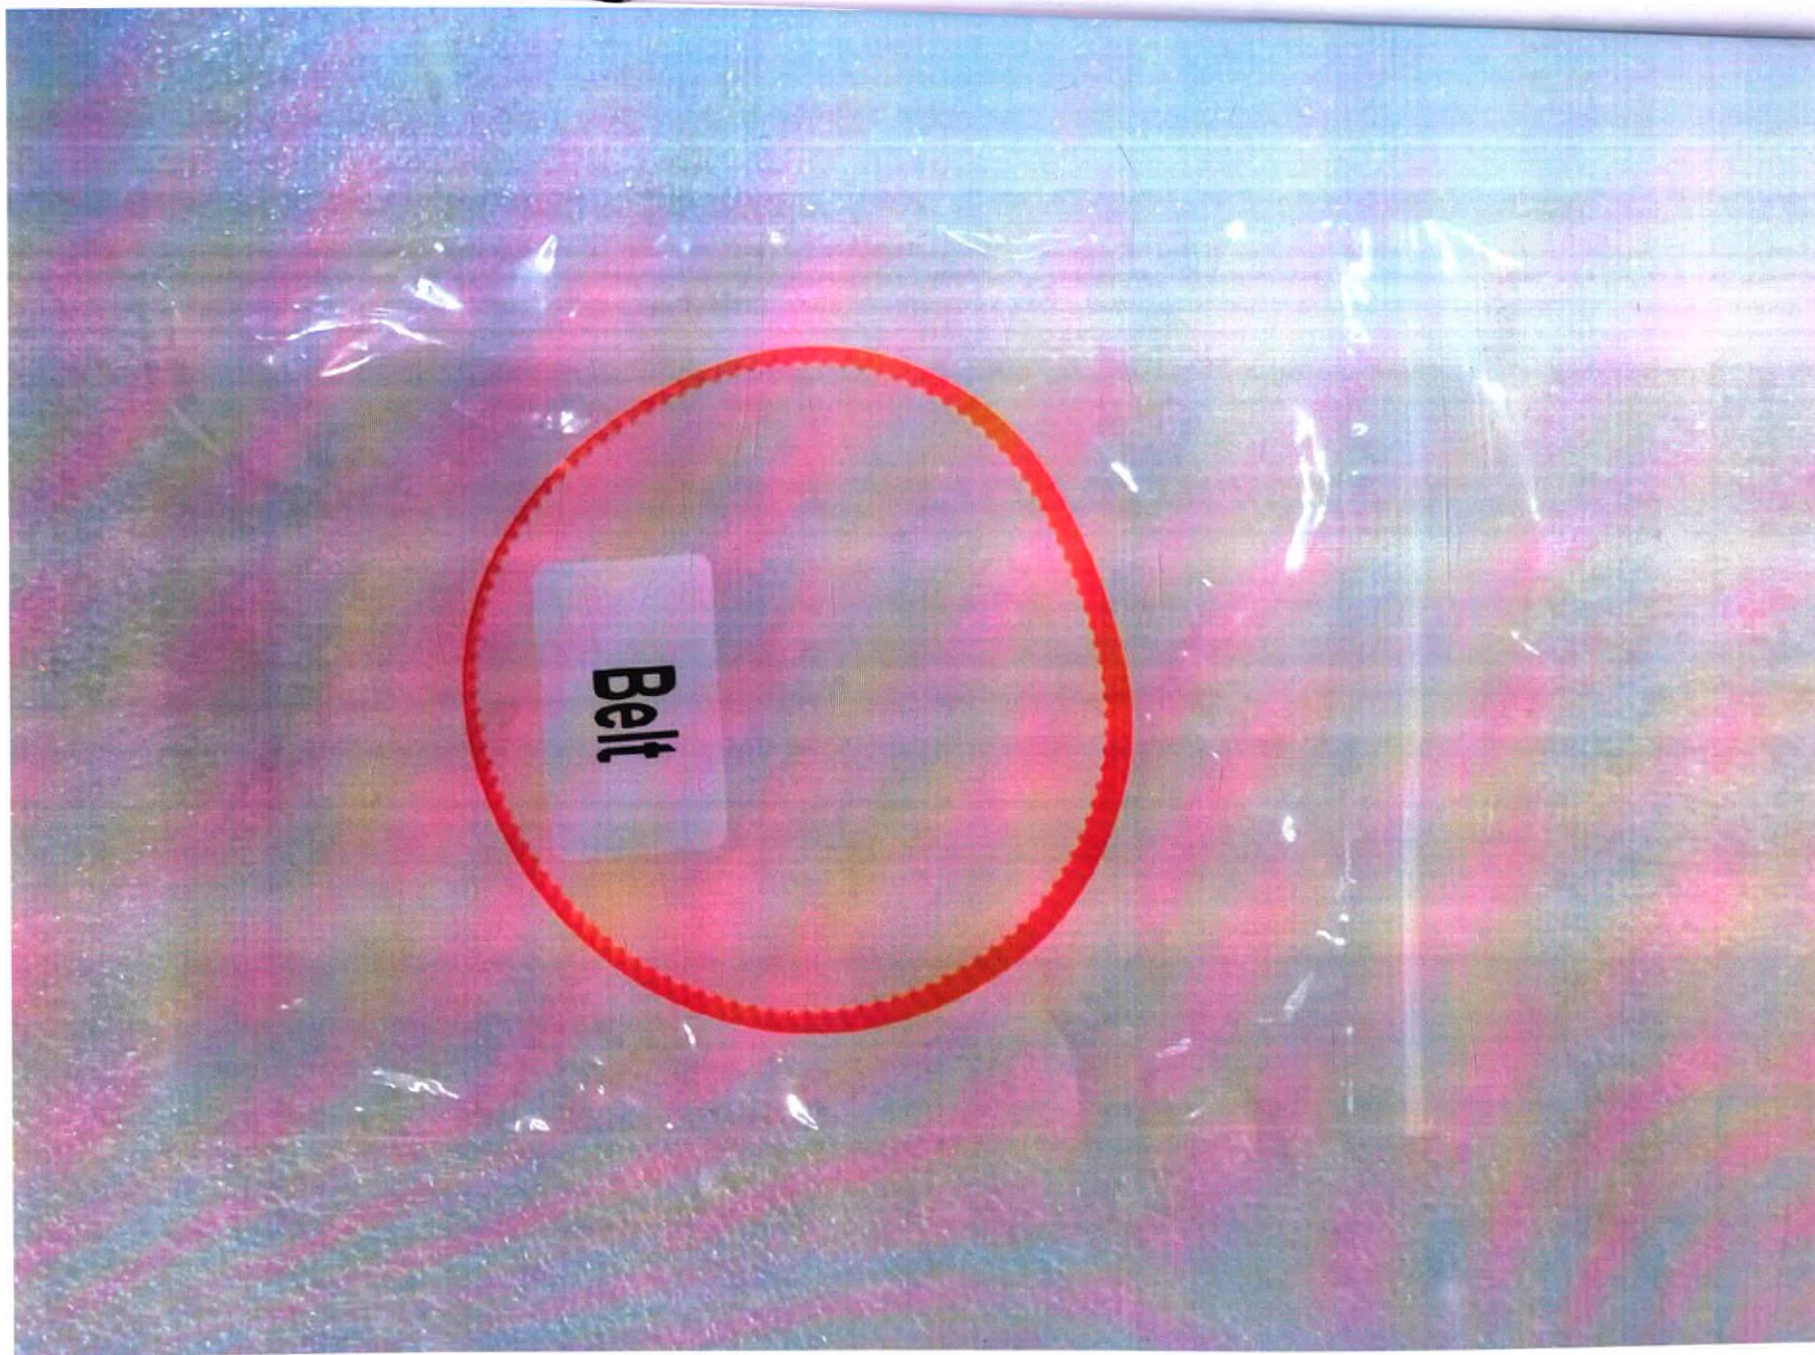


Рис. 30. Ремень для варианта исполнения Н9

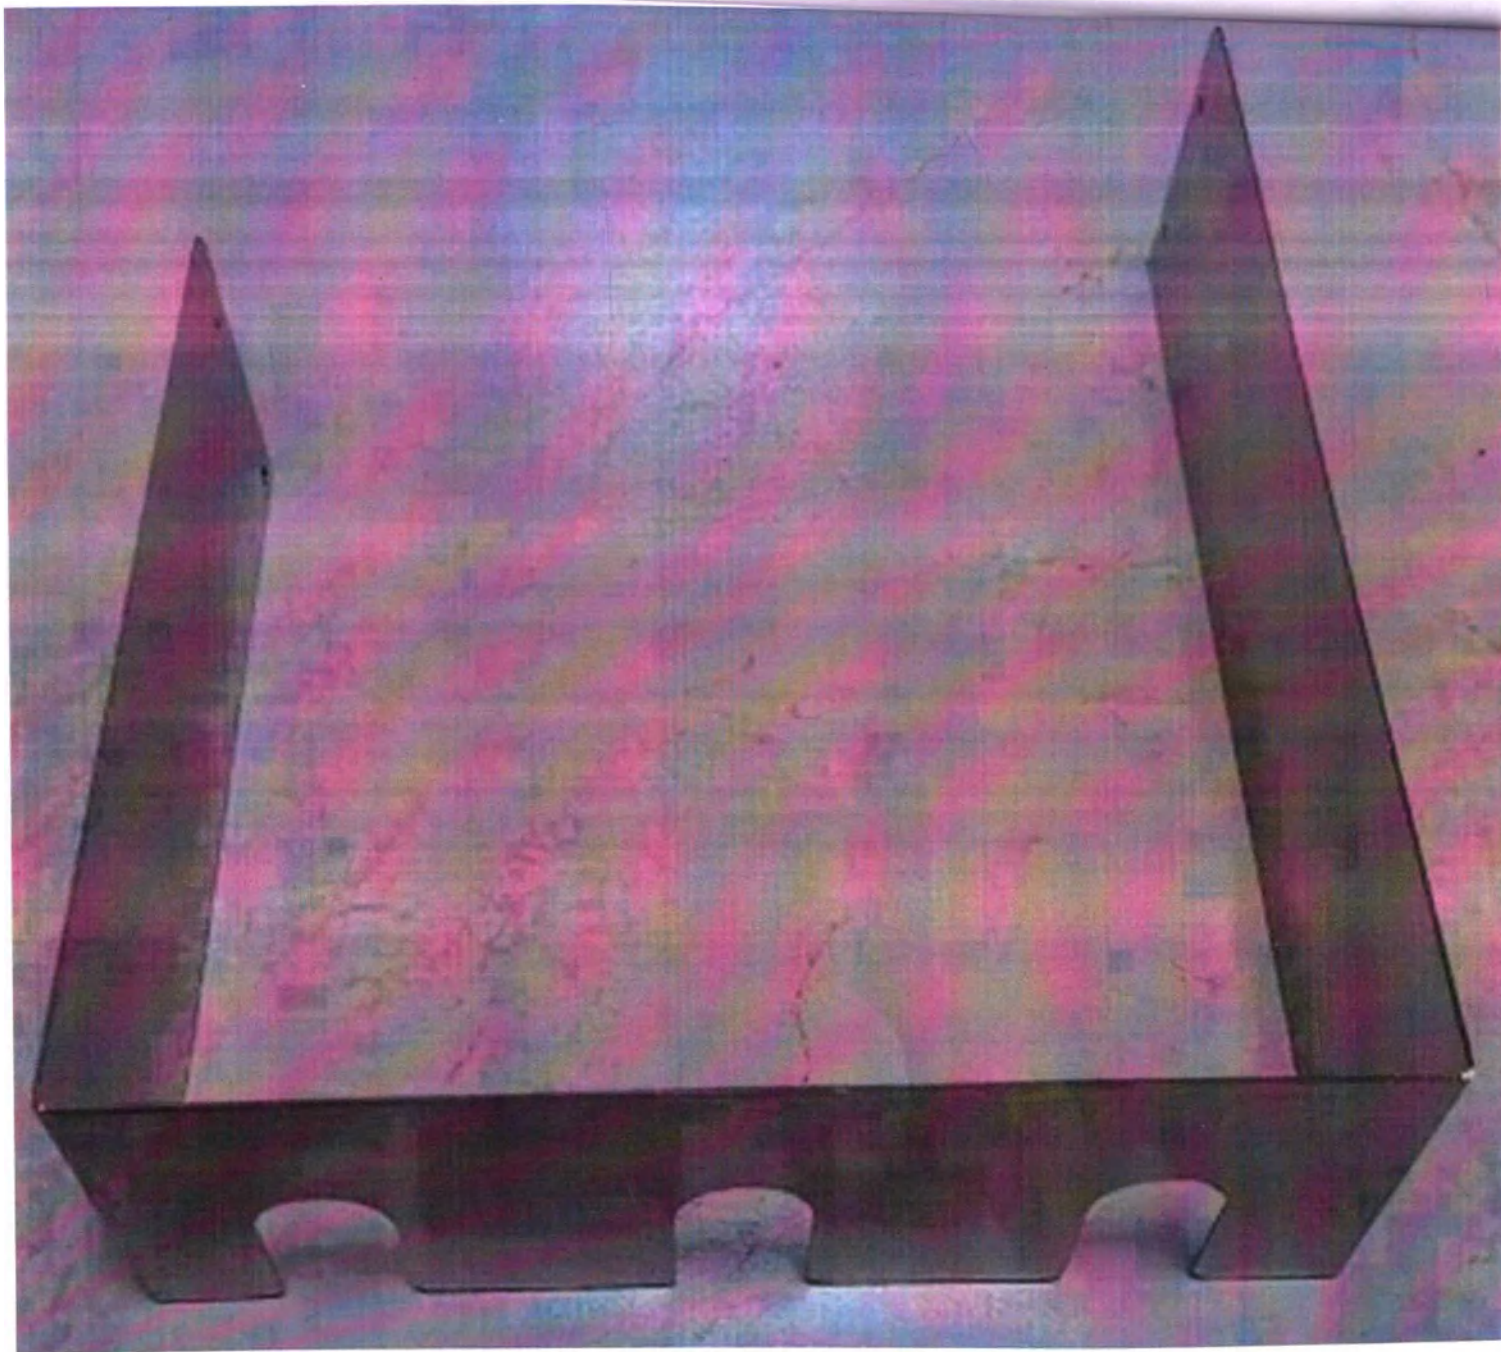


Рис. 31. Опорная рама для реагента АВС для варианта исполнения Н9

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 32 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5937789
КУСАЙЛО Р. В.