

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «НЭЙТИВ МЕДИКАЛ»

Блинов Д.А.

«16» декабря 2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Система рентгеновская стоматологическая интраоральная DVAS»,
производства Генорей Ко., Лтд (Genoray Co., Ltd.), Республика Корея

Система рентгеновская стоматологическая интраоральная DVAS-C

Общий вид

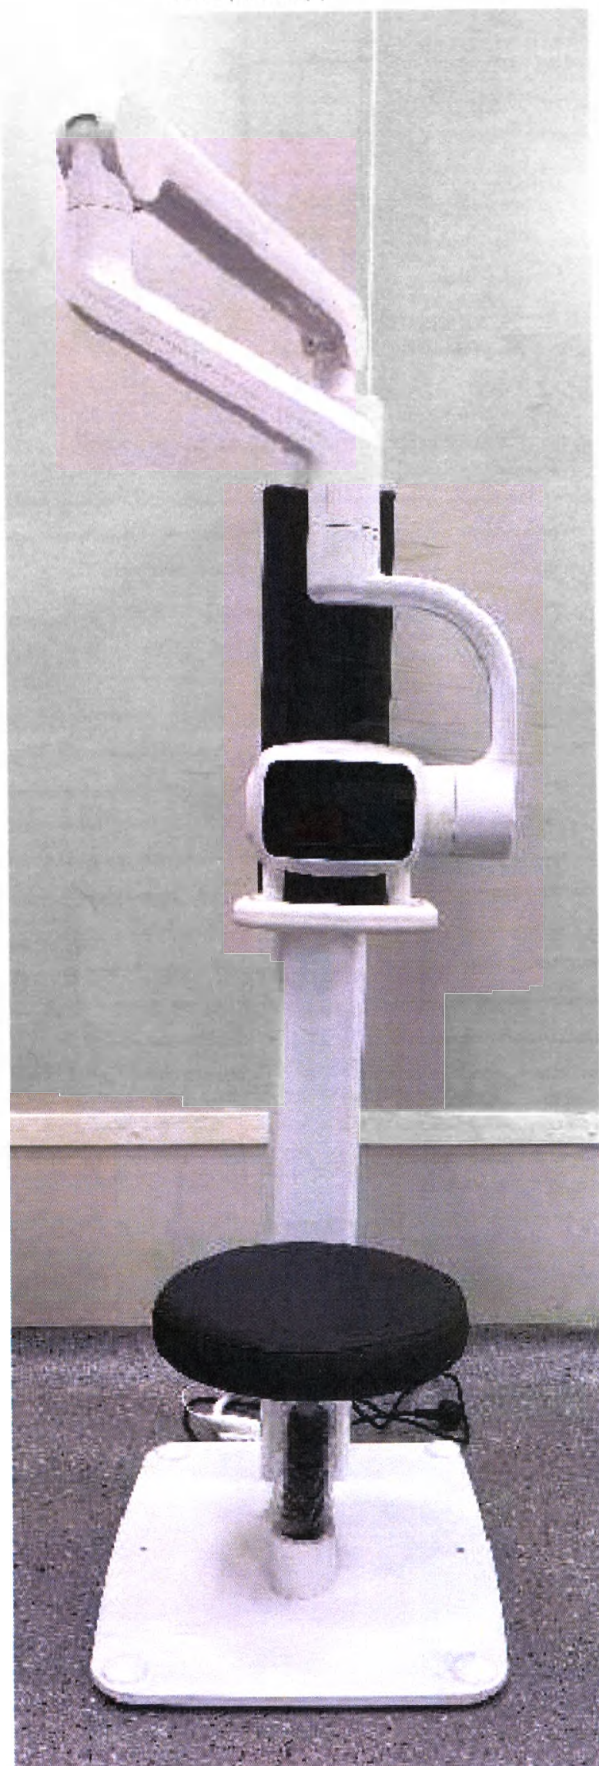

Основная маркировка

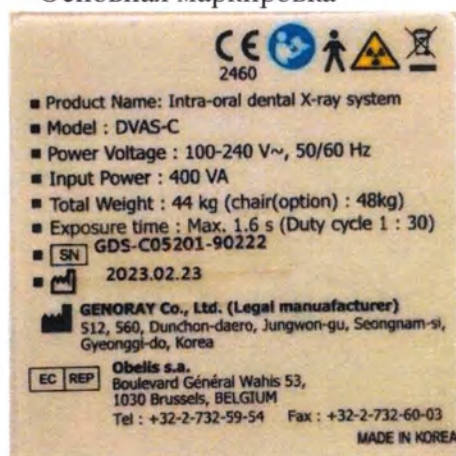


Макет русскоязычной маркировки



Генератор рентгеновского излучения




Маркировка генератора рентгеновского излучения

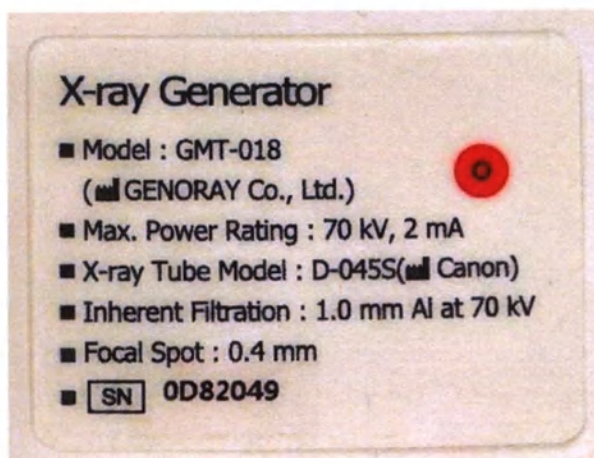

Пульт управления



Кнопка экспозиции

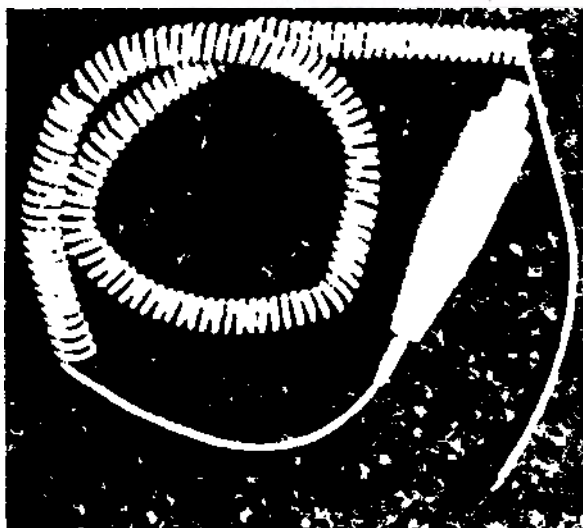

Кабель питания



Транспортная тара




Маркировка транспортной тары




Система рентгеновская стоматологическая интраоральная DVAS-M


Общий вид

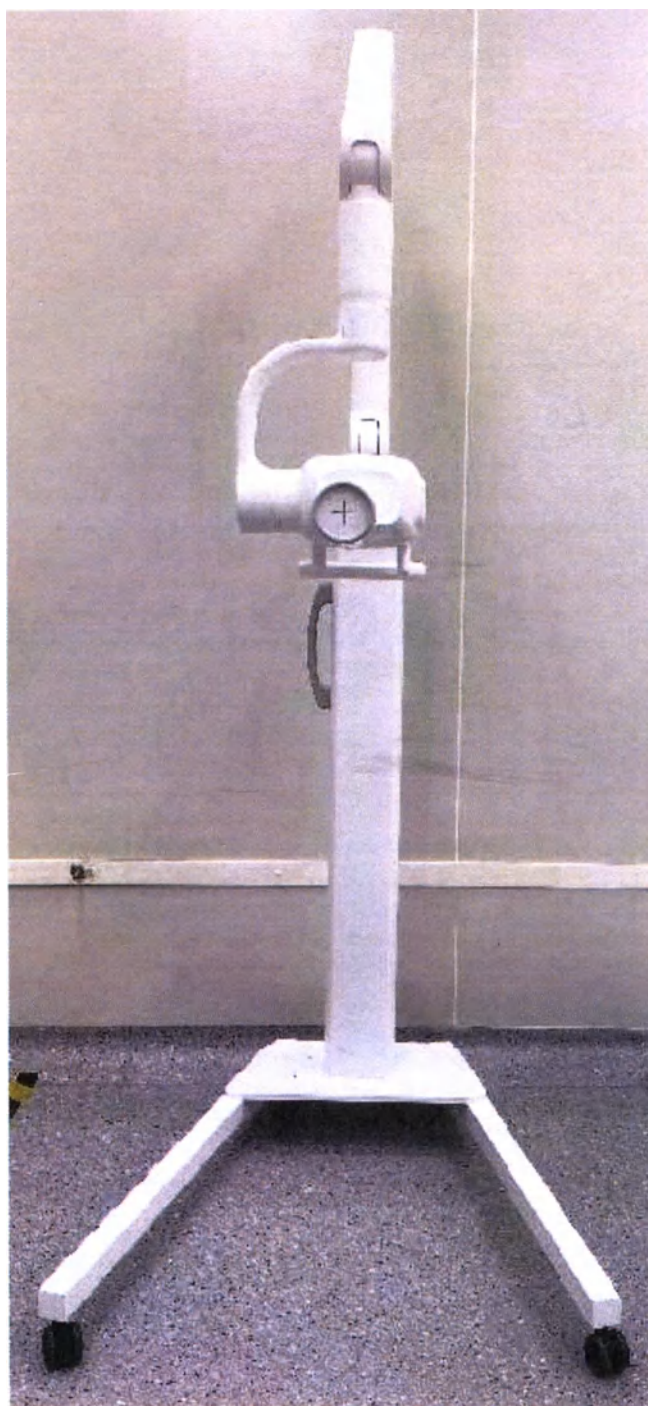


Основная маркировка

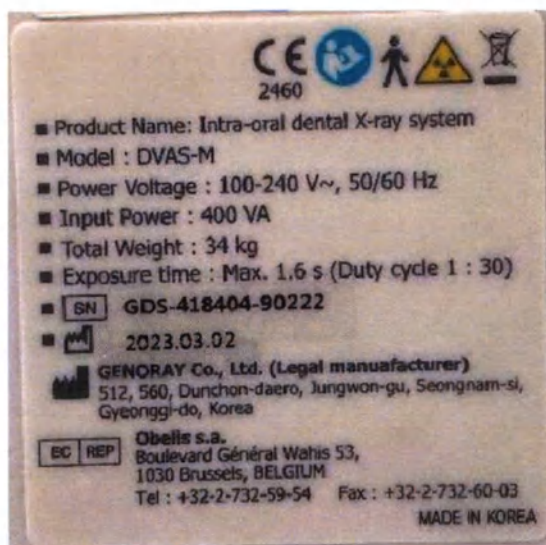


Макет русскоязычной маркировки

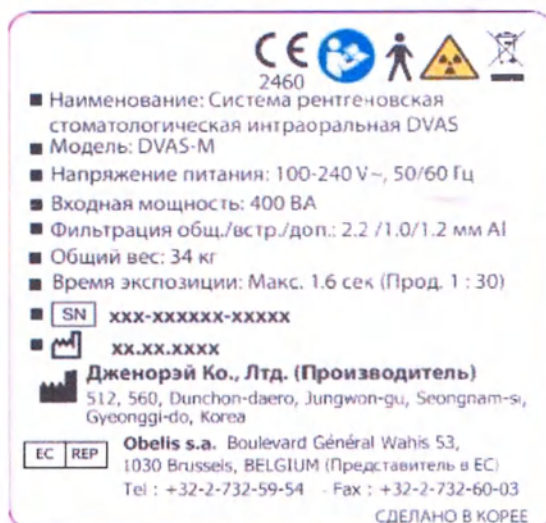

Генератор рентгеновского излучения

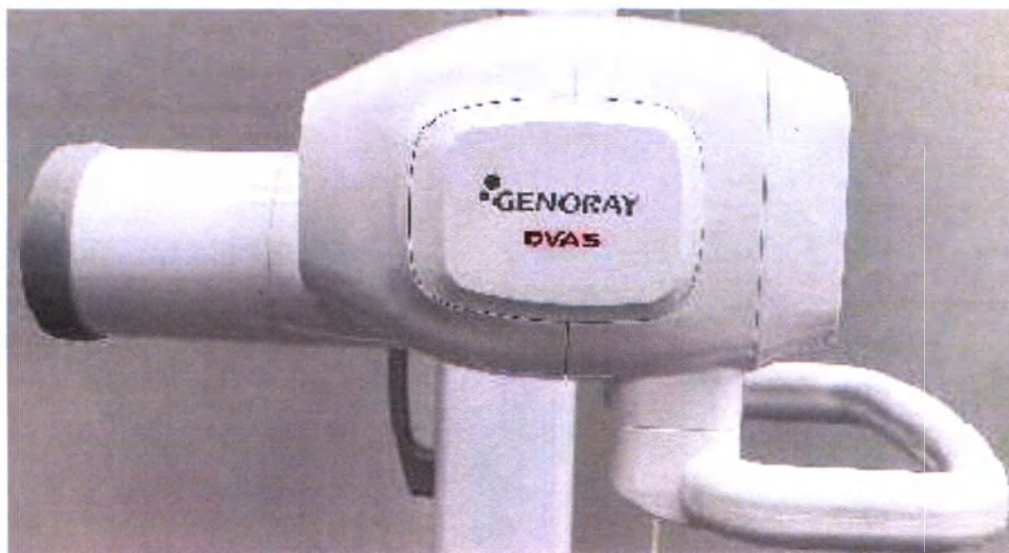


Маркировка генератора рентгеновского излучения

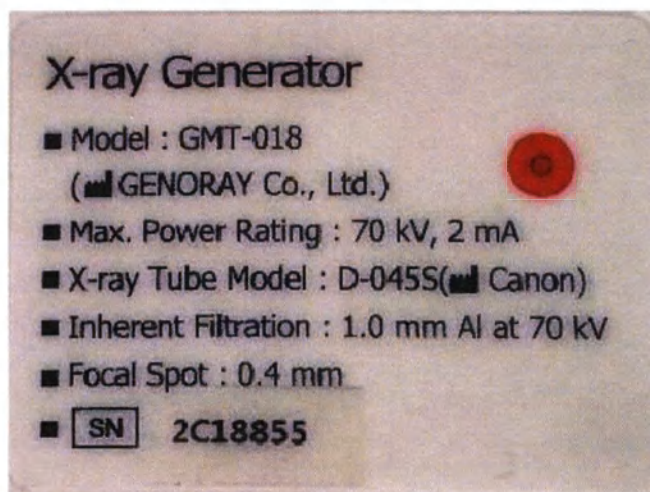


Пульт управления



Кнопка экспозиции

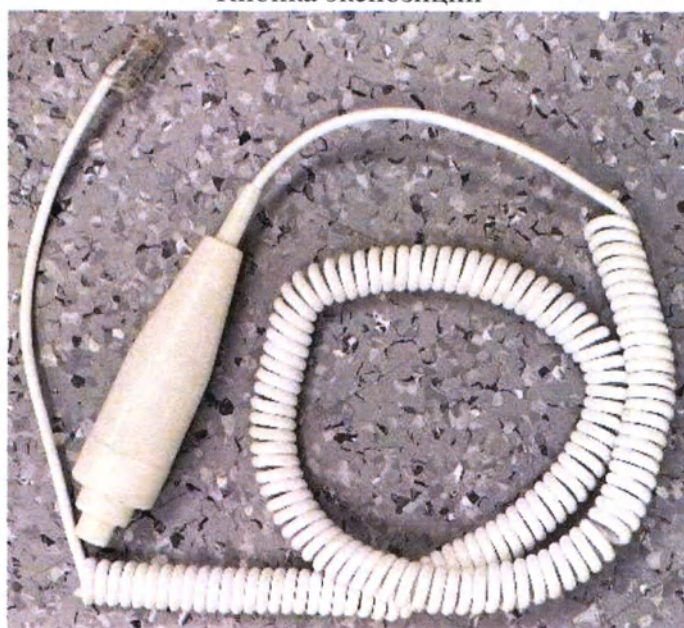


Кабель питания

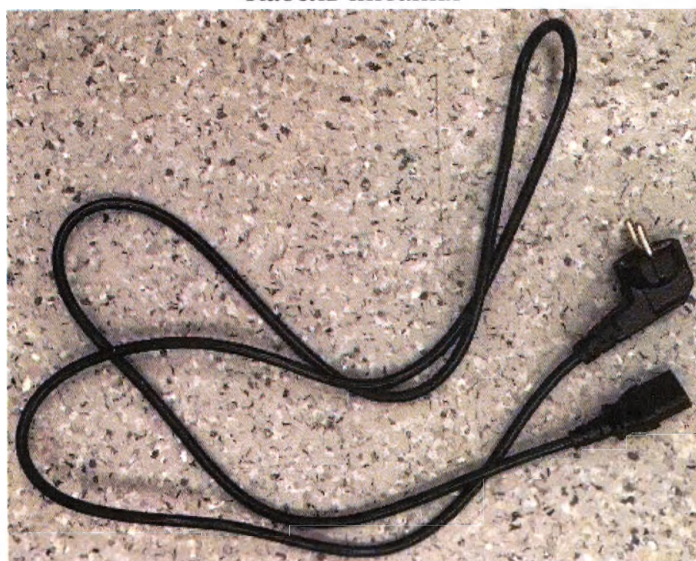

Транспортная тара




Маркировка транспортной тары

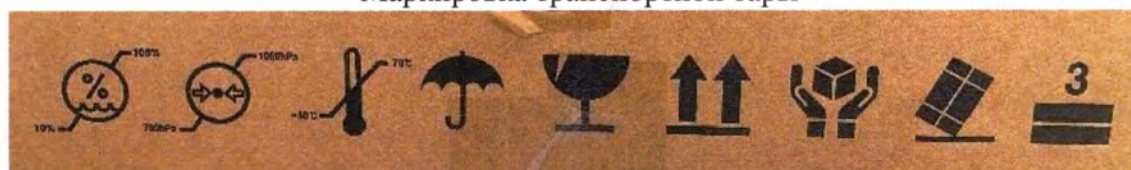


Система рентгеновская стоматологическая интраоральная DVAS-W

Общий вид

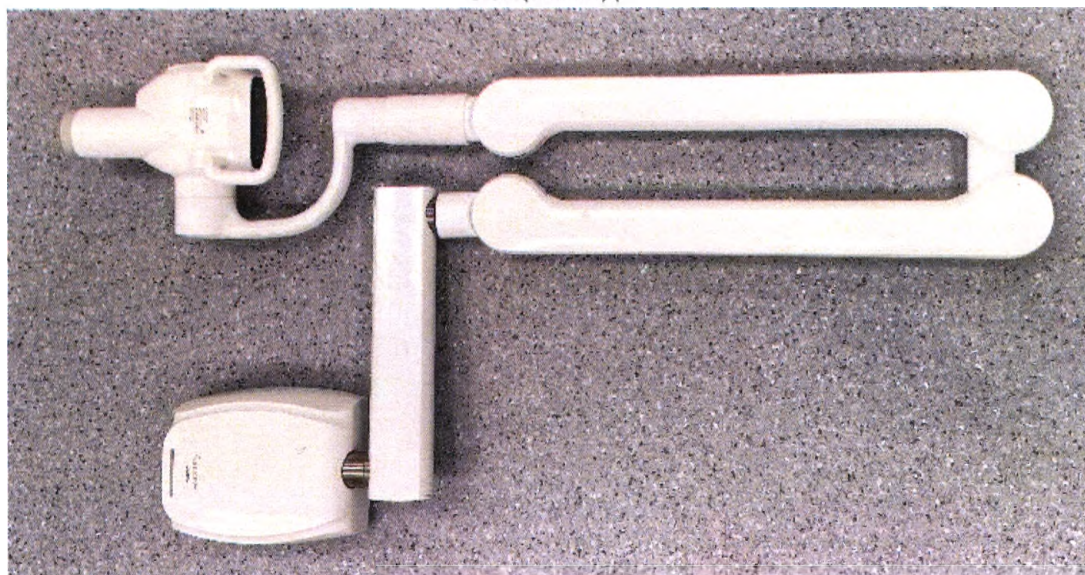

Основная маркировка

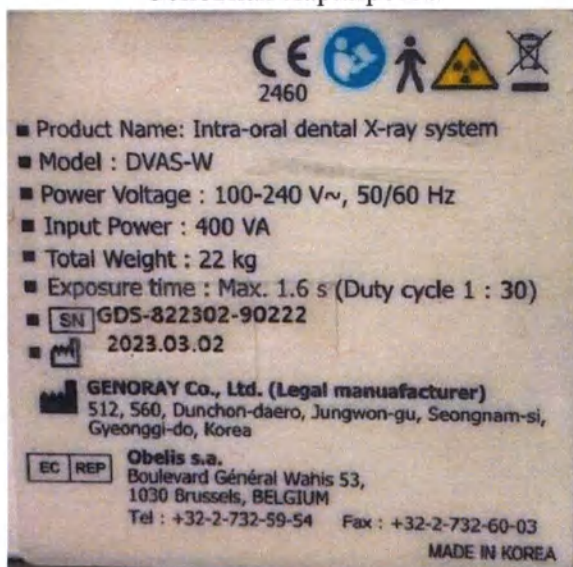


Макет русскоязычной маркировки



Генератор рентгеновского излучения




Маркировка генератора рентгеновского излучения

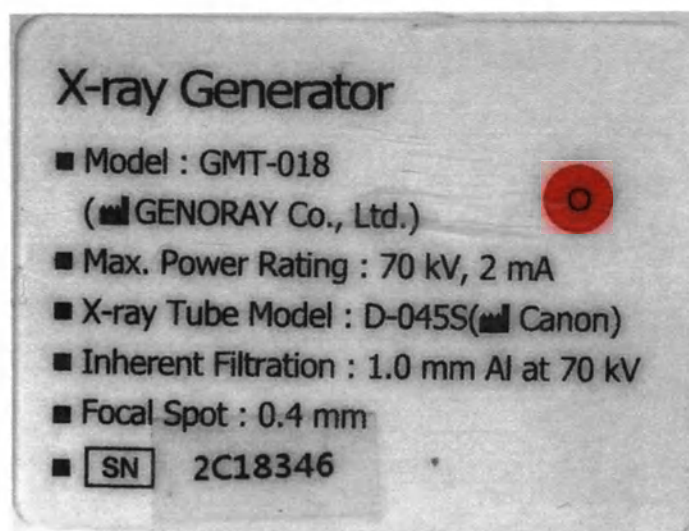

Пульт управления



Кнопка экспозиции

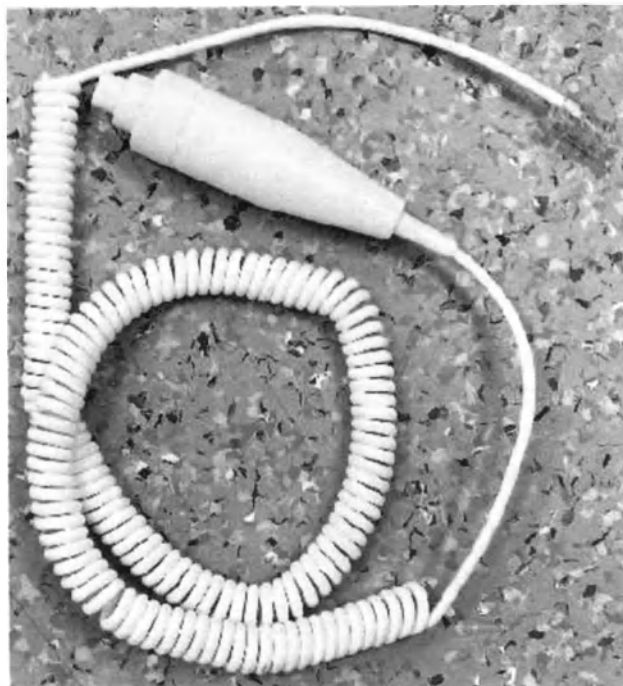

Кабель питания



Транспортная тара



Маркировка транспортной тары



CE
2460

 **GENRAY**

☐ **DVAS-W**

☐ **DVAS-M**

Digital Valuable Advanced Standard X-ray

Пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью 13

(Тринадцат) страниц.

Генеральный директор
ООО "НЭЙТИВ МЕДИКАЛ"

Блинов Д.А.

