



**Общество с ограниченной
ответственностью
«ОПТИКУМ»**


УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Оптикум»
Бойков С.Ю.

«24» апреля 2024 г.

**Фотографические изображения вариантов
исполнения медицинского изделия
«Материалы хирургические шовные
«Оптикум» стерильные
по ТУ 9393-004-93420730-2008**

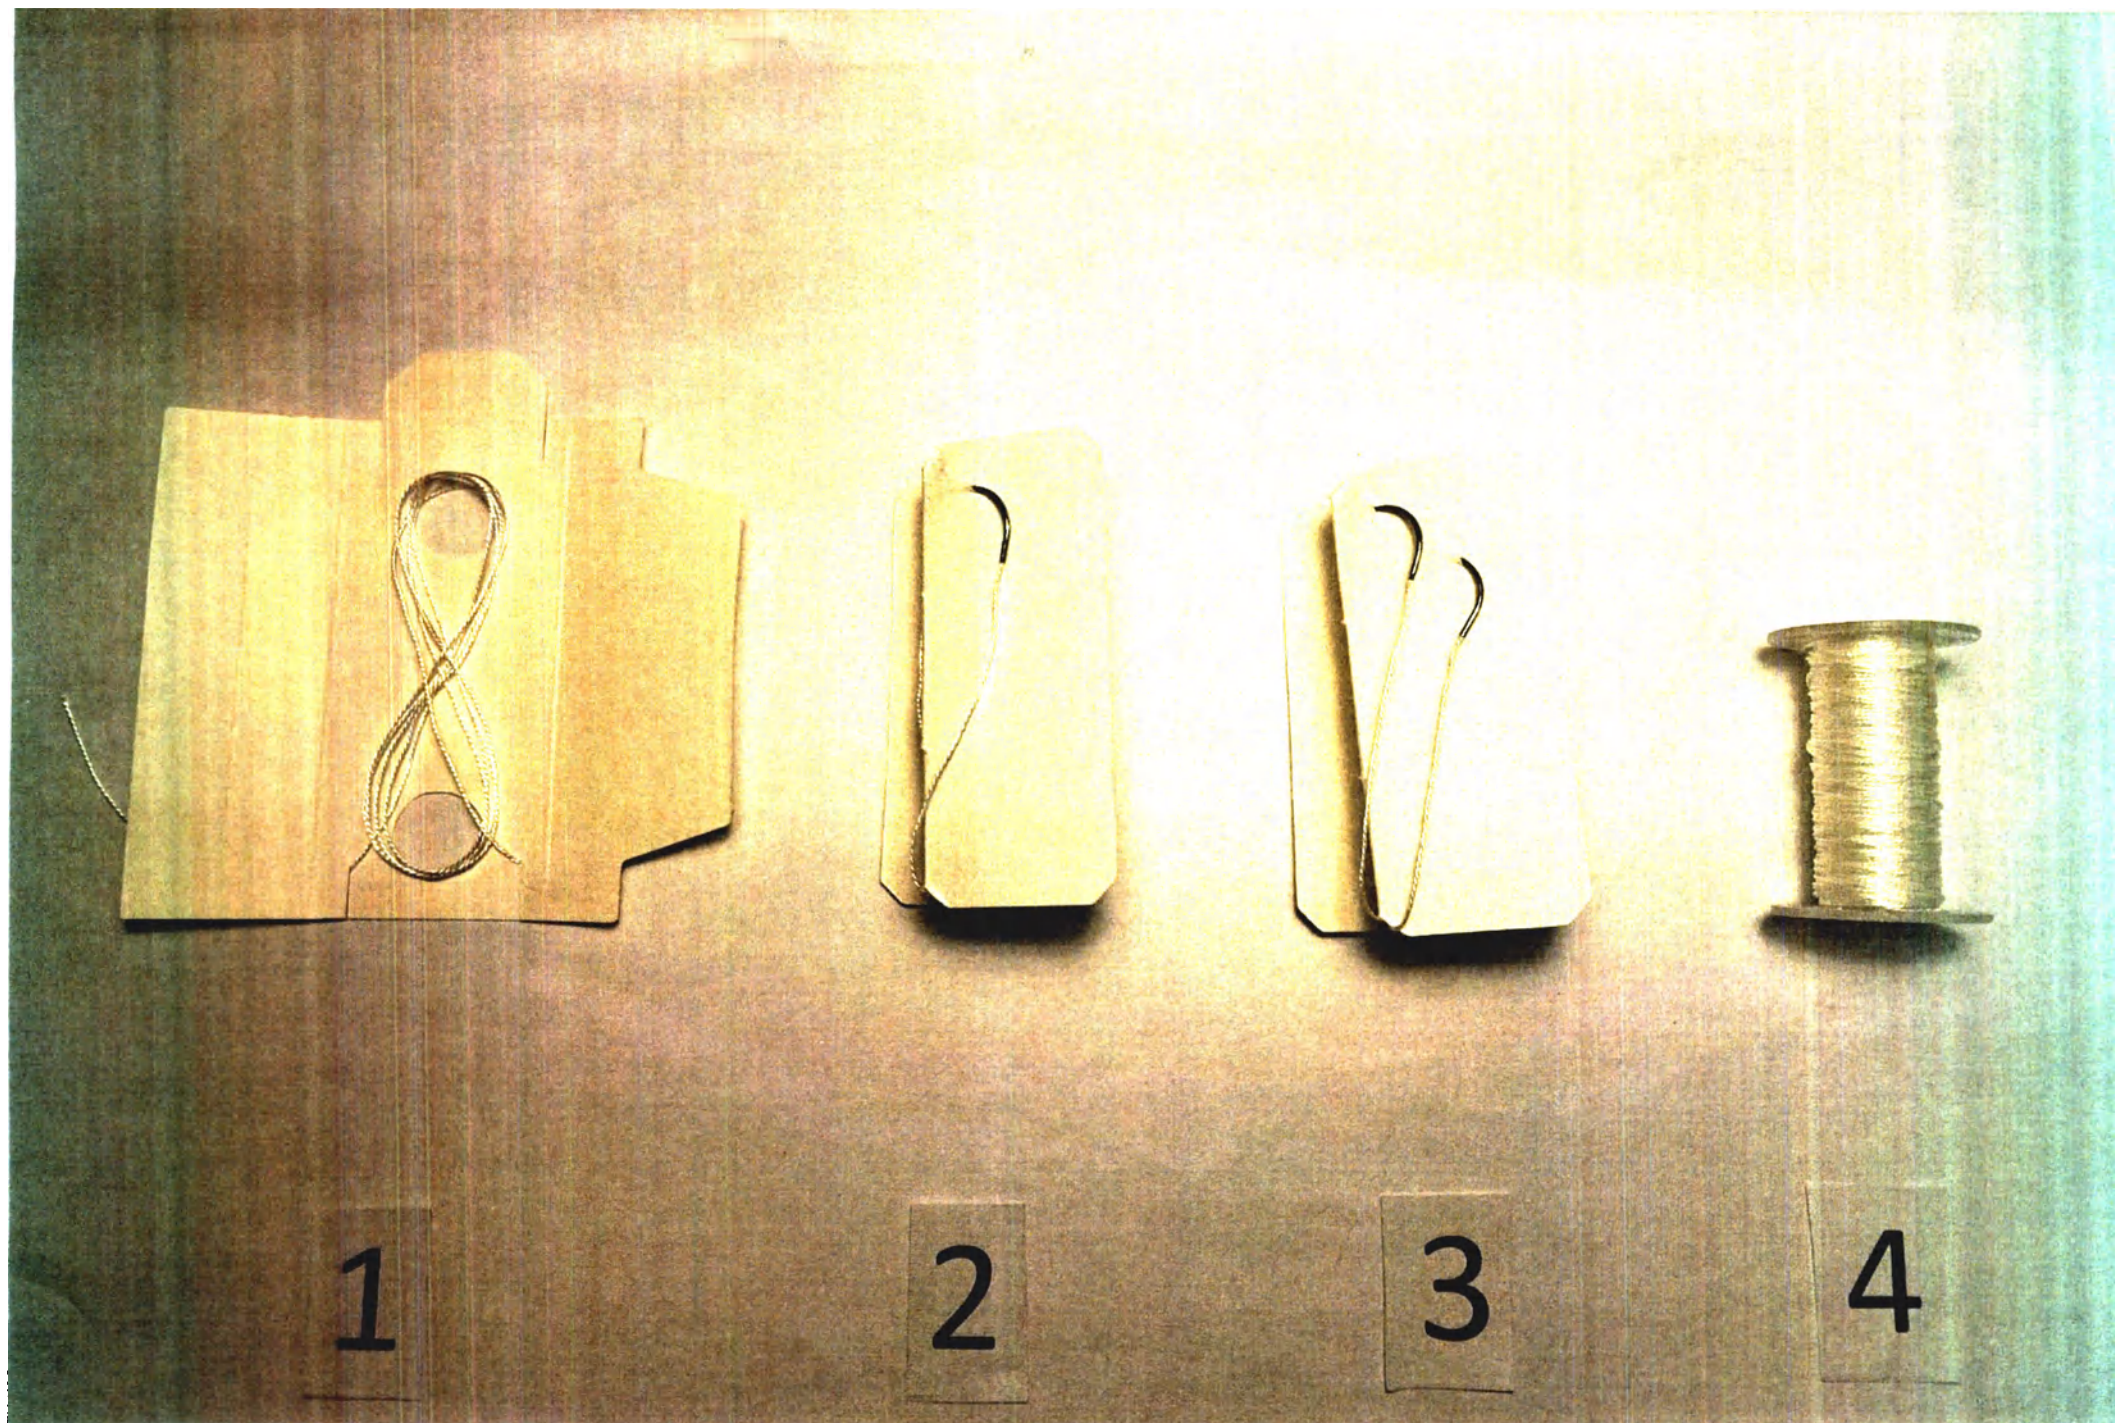


1

2


3

4


1 и 4 Нить полиэфирная коучная неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4- на катушке)
 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
 2 и 3 Нить полиэфирная крученая неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

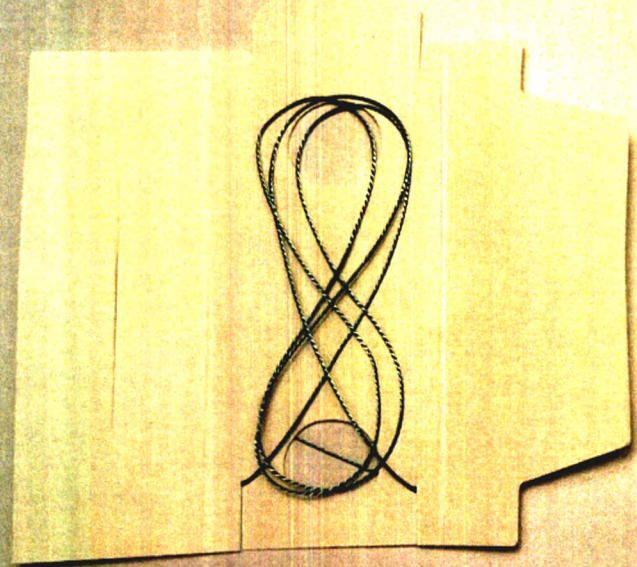

1

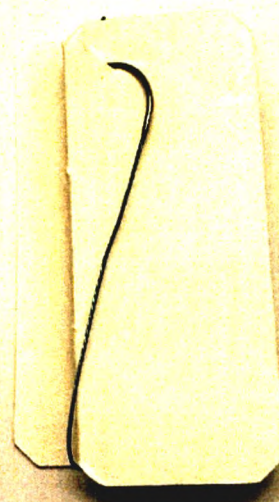


2

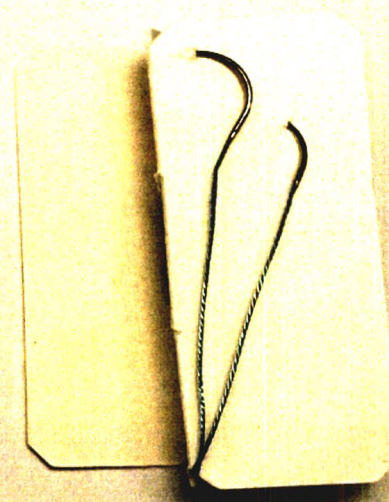

3



4

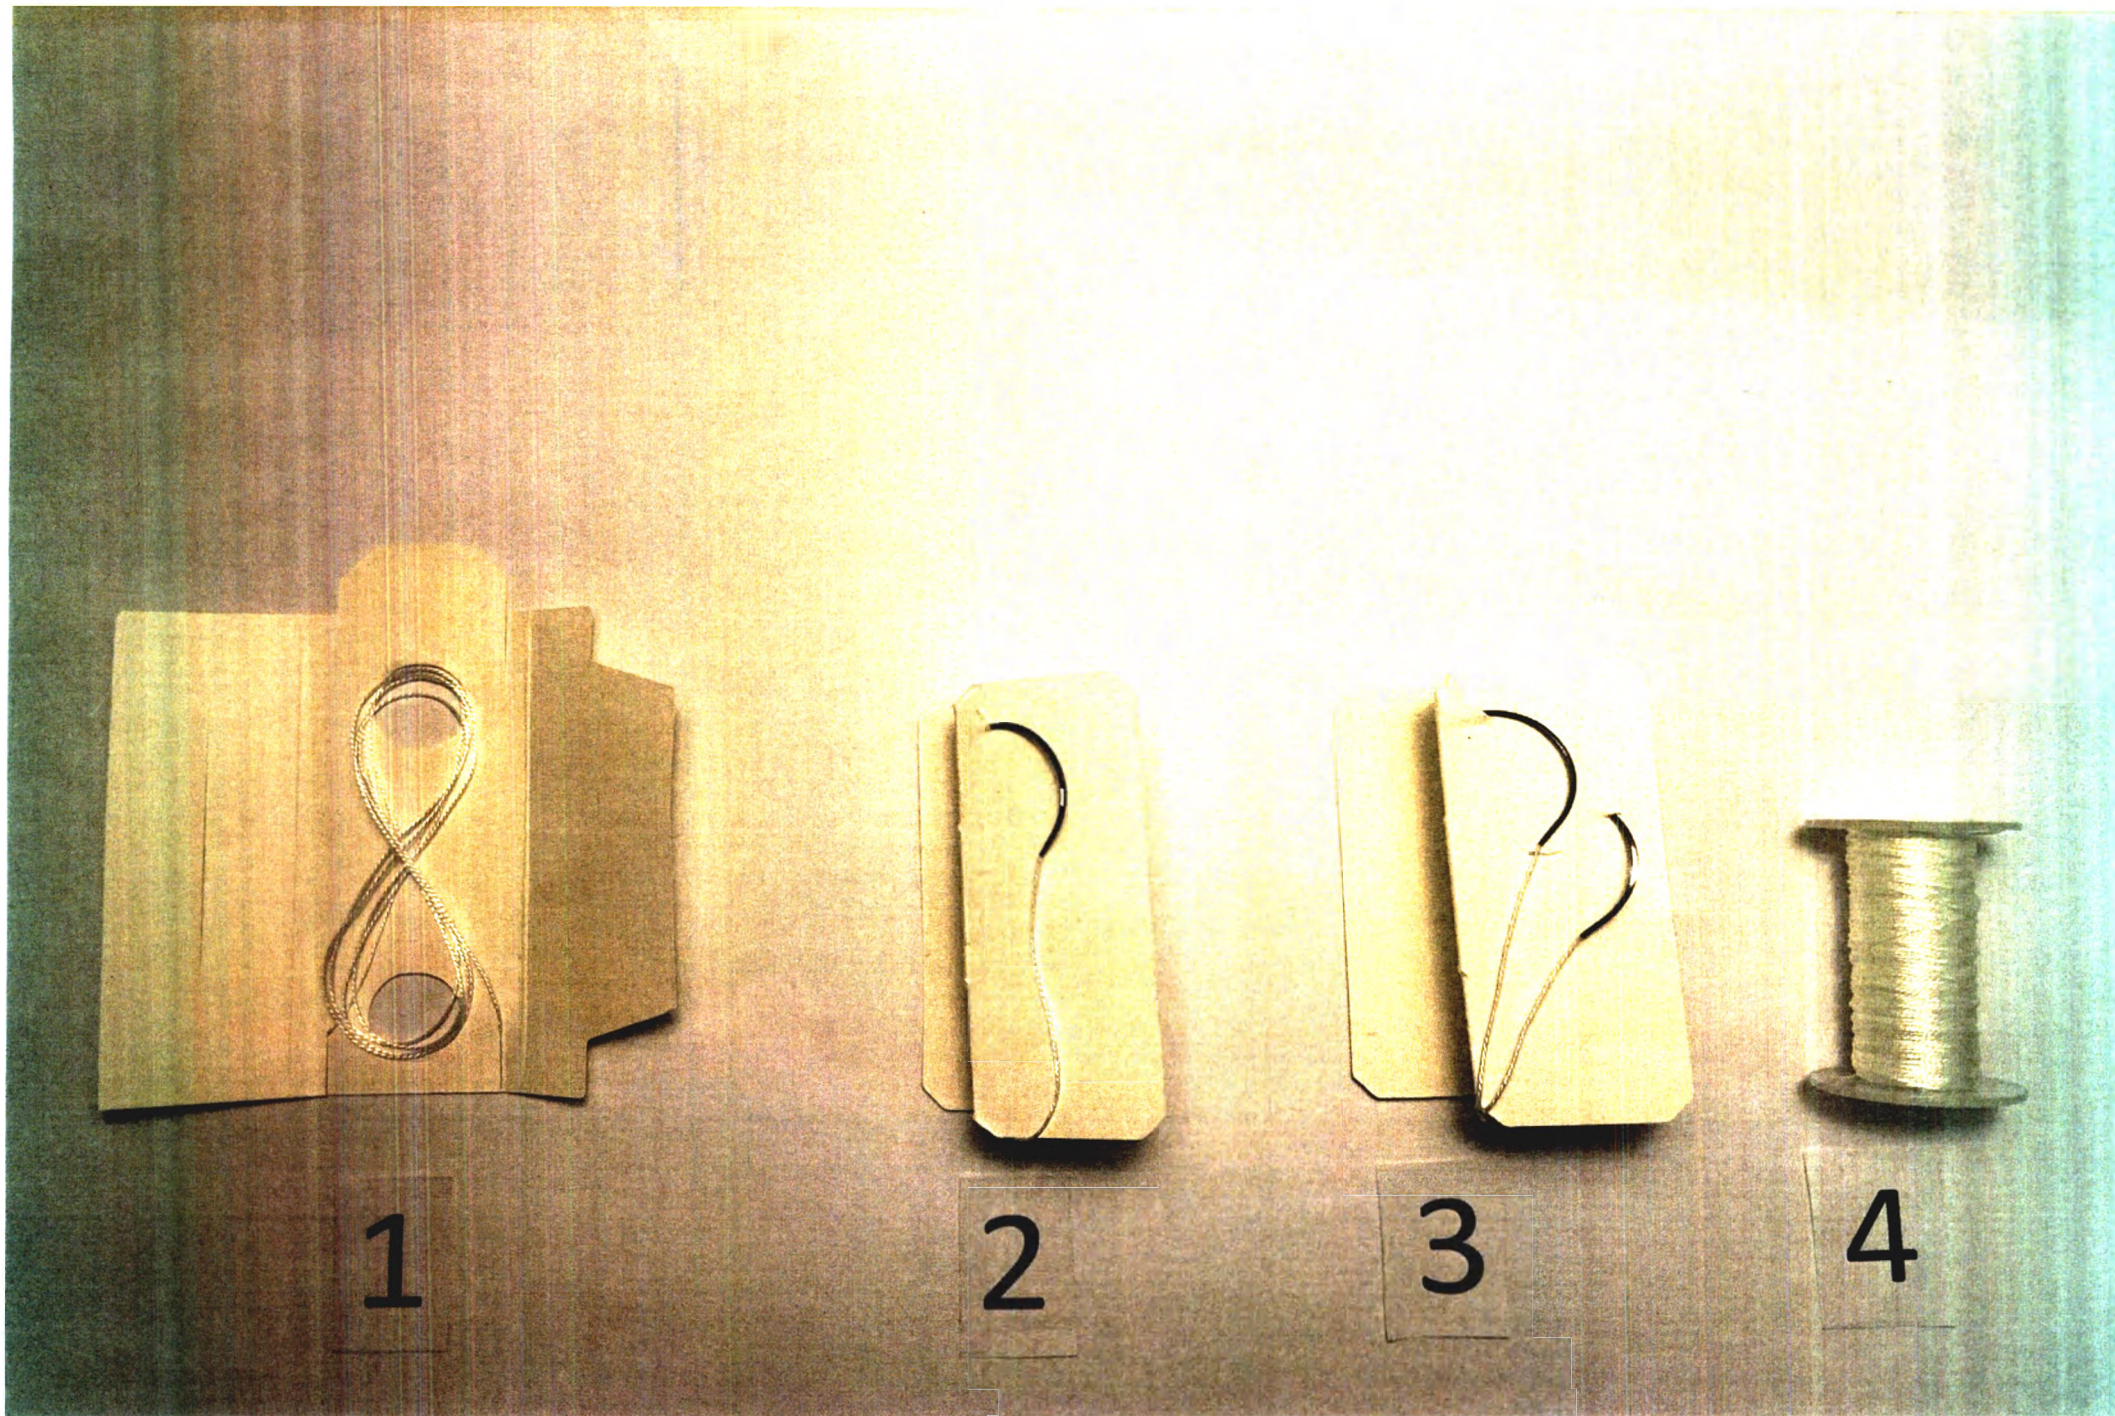


1


2

3

4

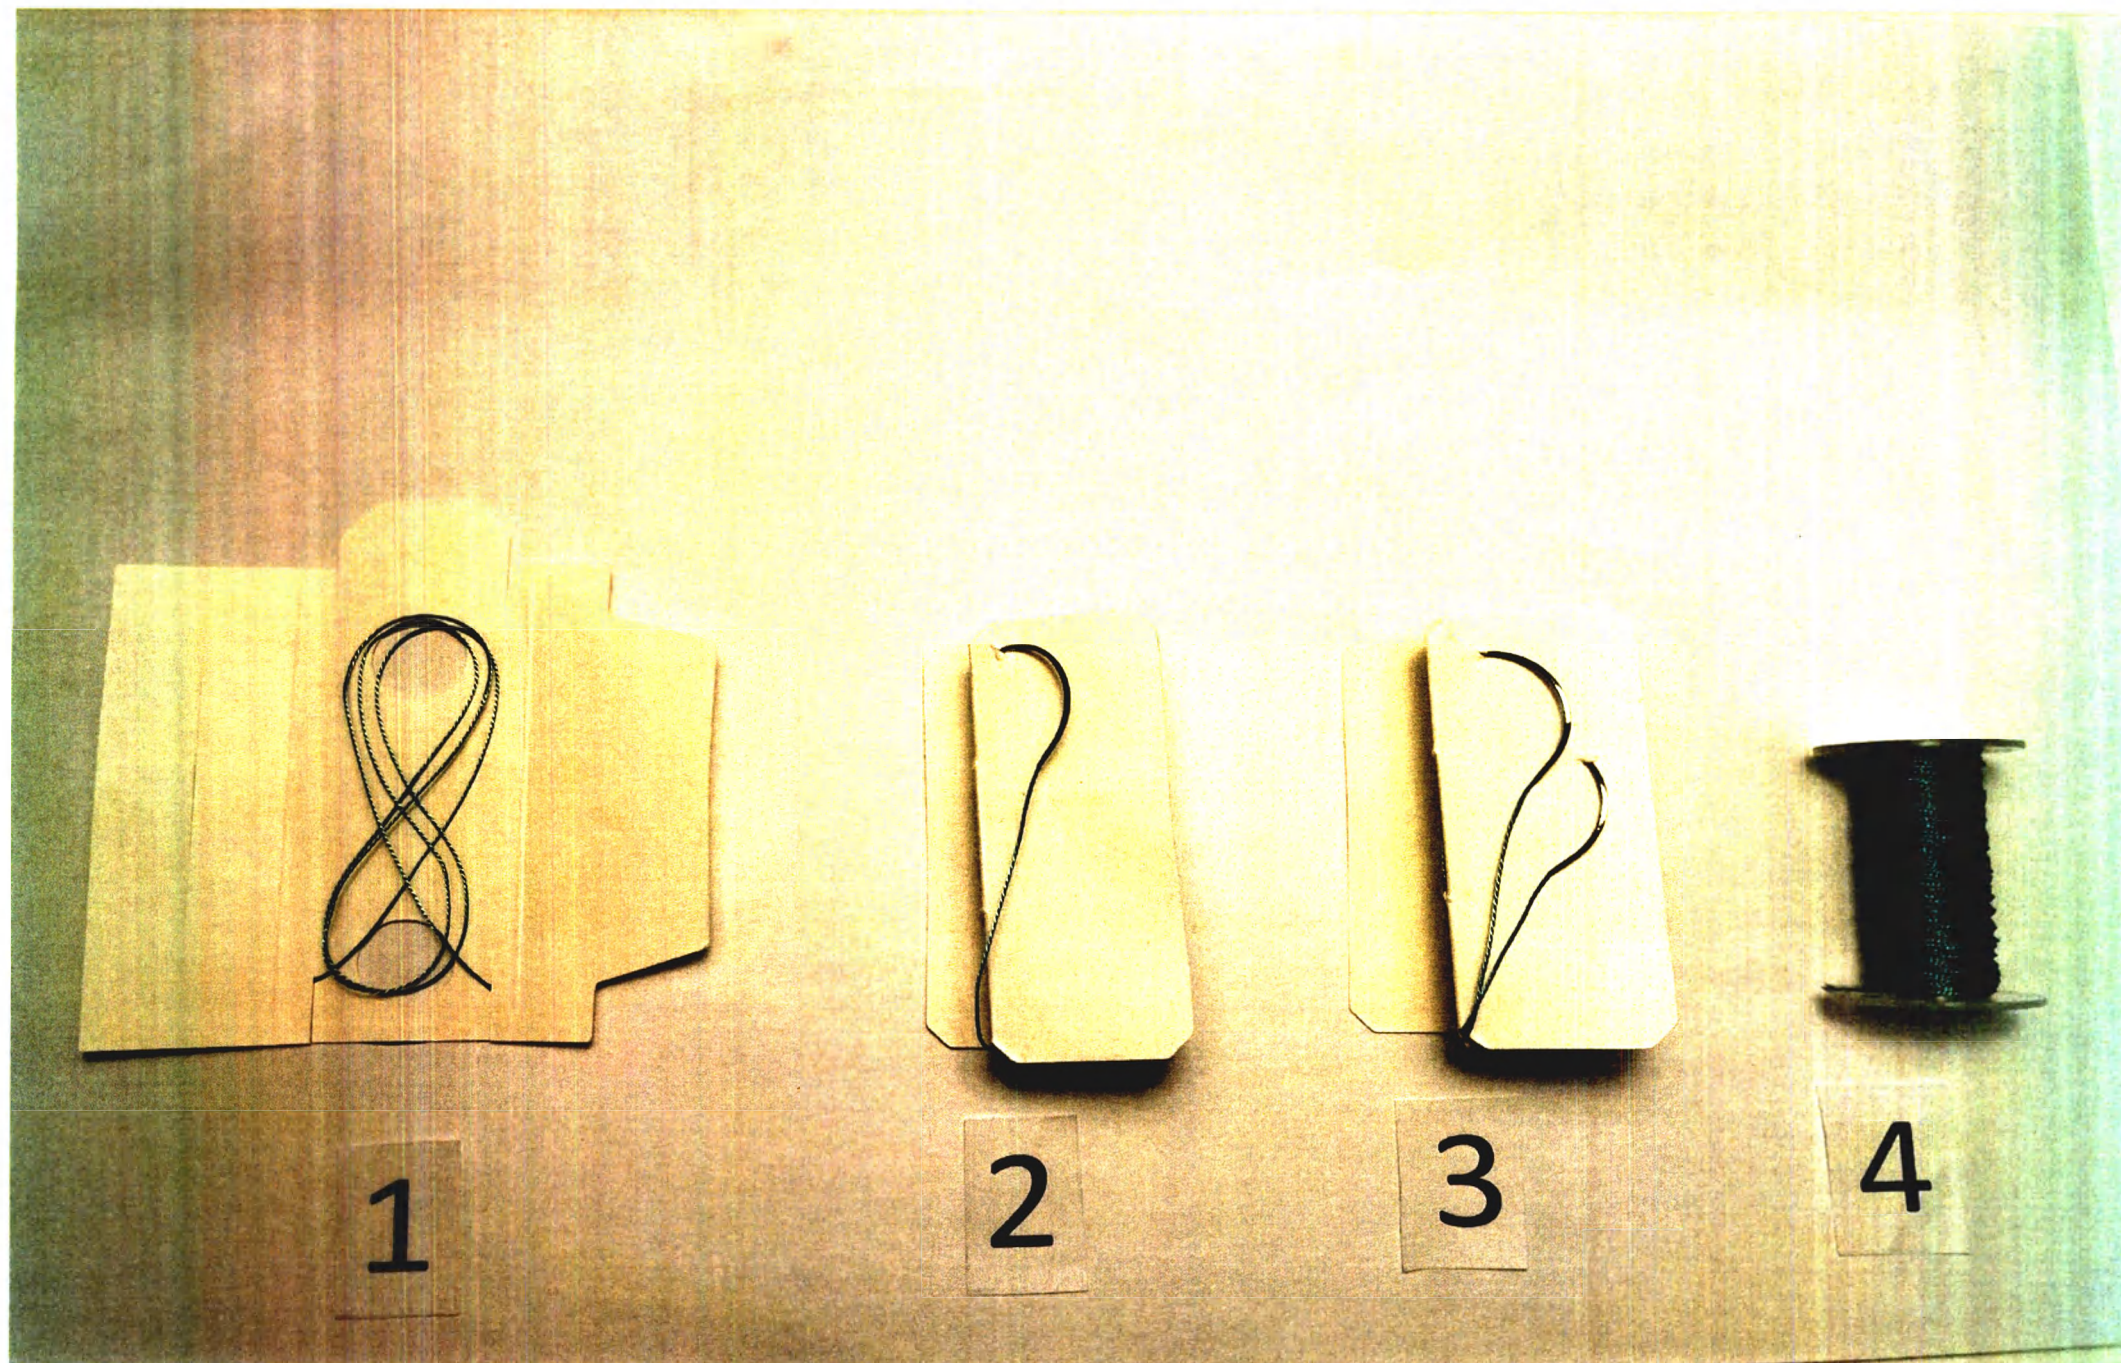


1 и 4 Нить полиэфирная крученая с фторполимерным покрытием окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1-в отрезке, 4-на катушке)
2 и 3 Нить полиэфирная крученая с фторполимерным покрытием окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

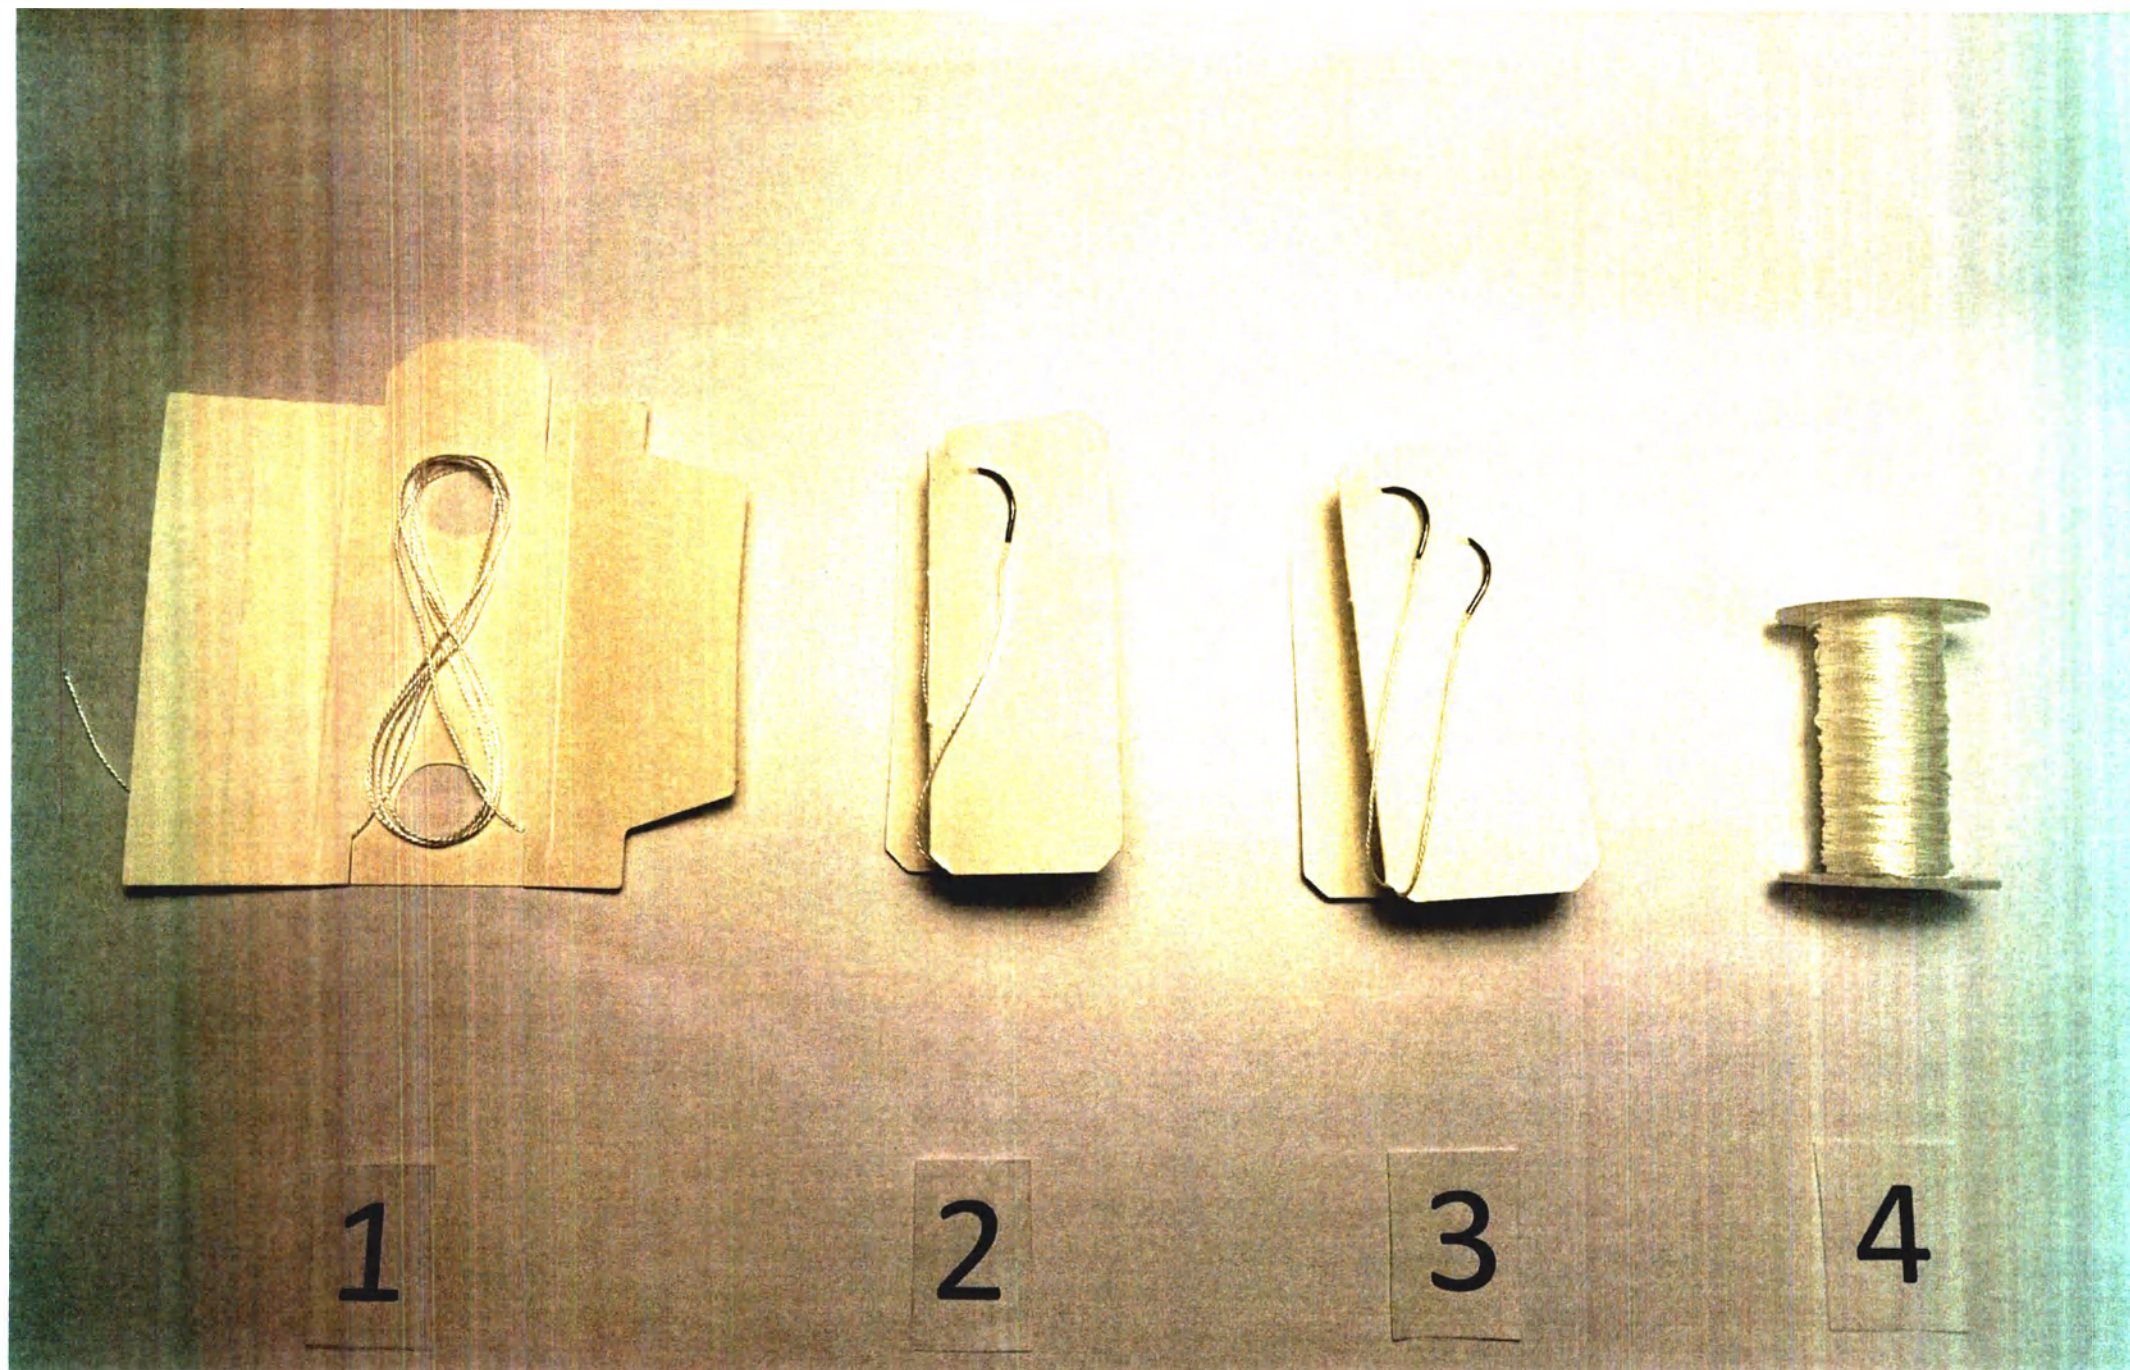


1 и 4 Нить полиэфирная крученая с силиконовым покрытием неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4- на катушке)

2 и 3 Нить полиэфирная крученая с силиконовым покрытием неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

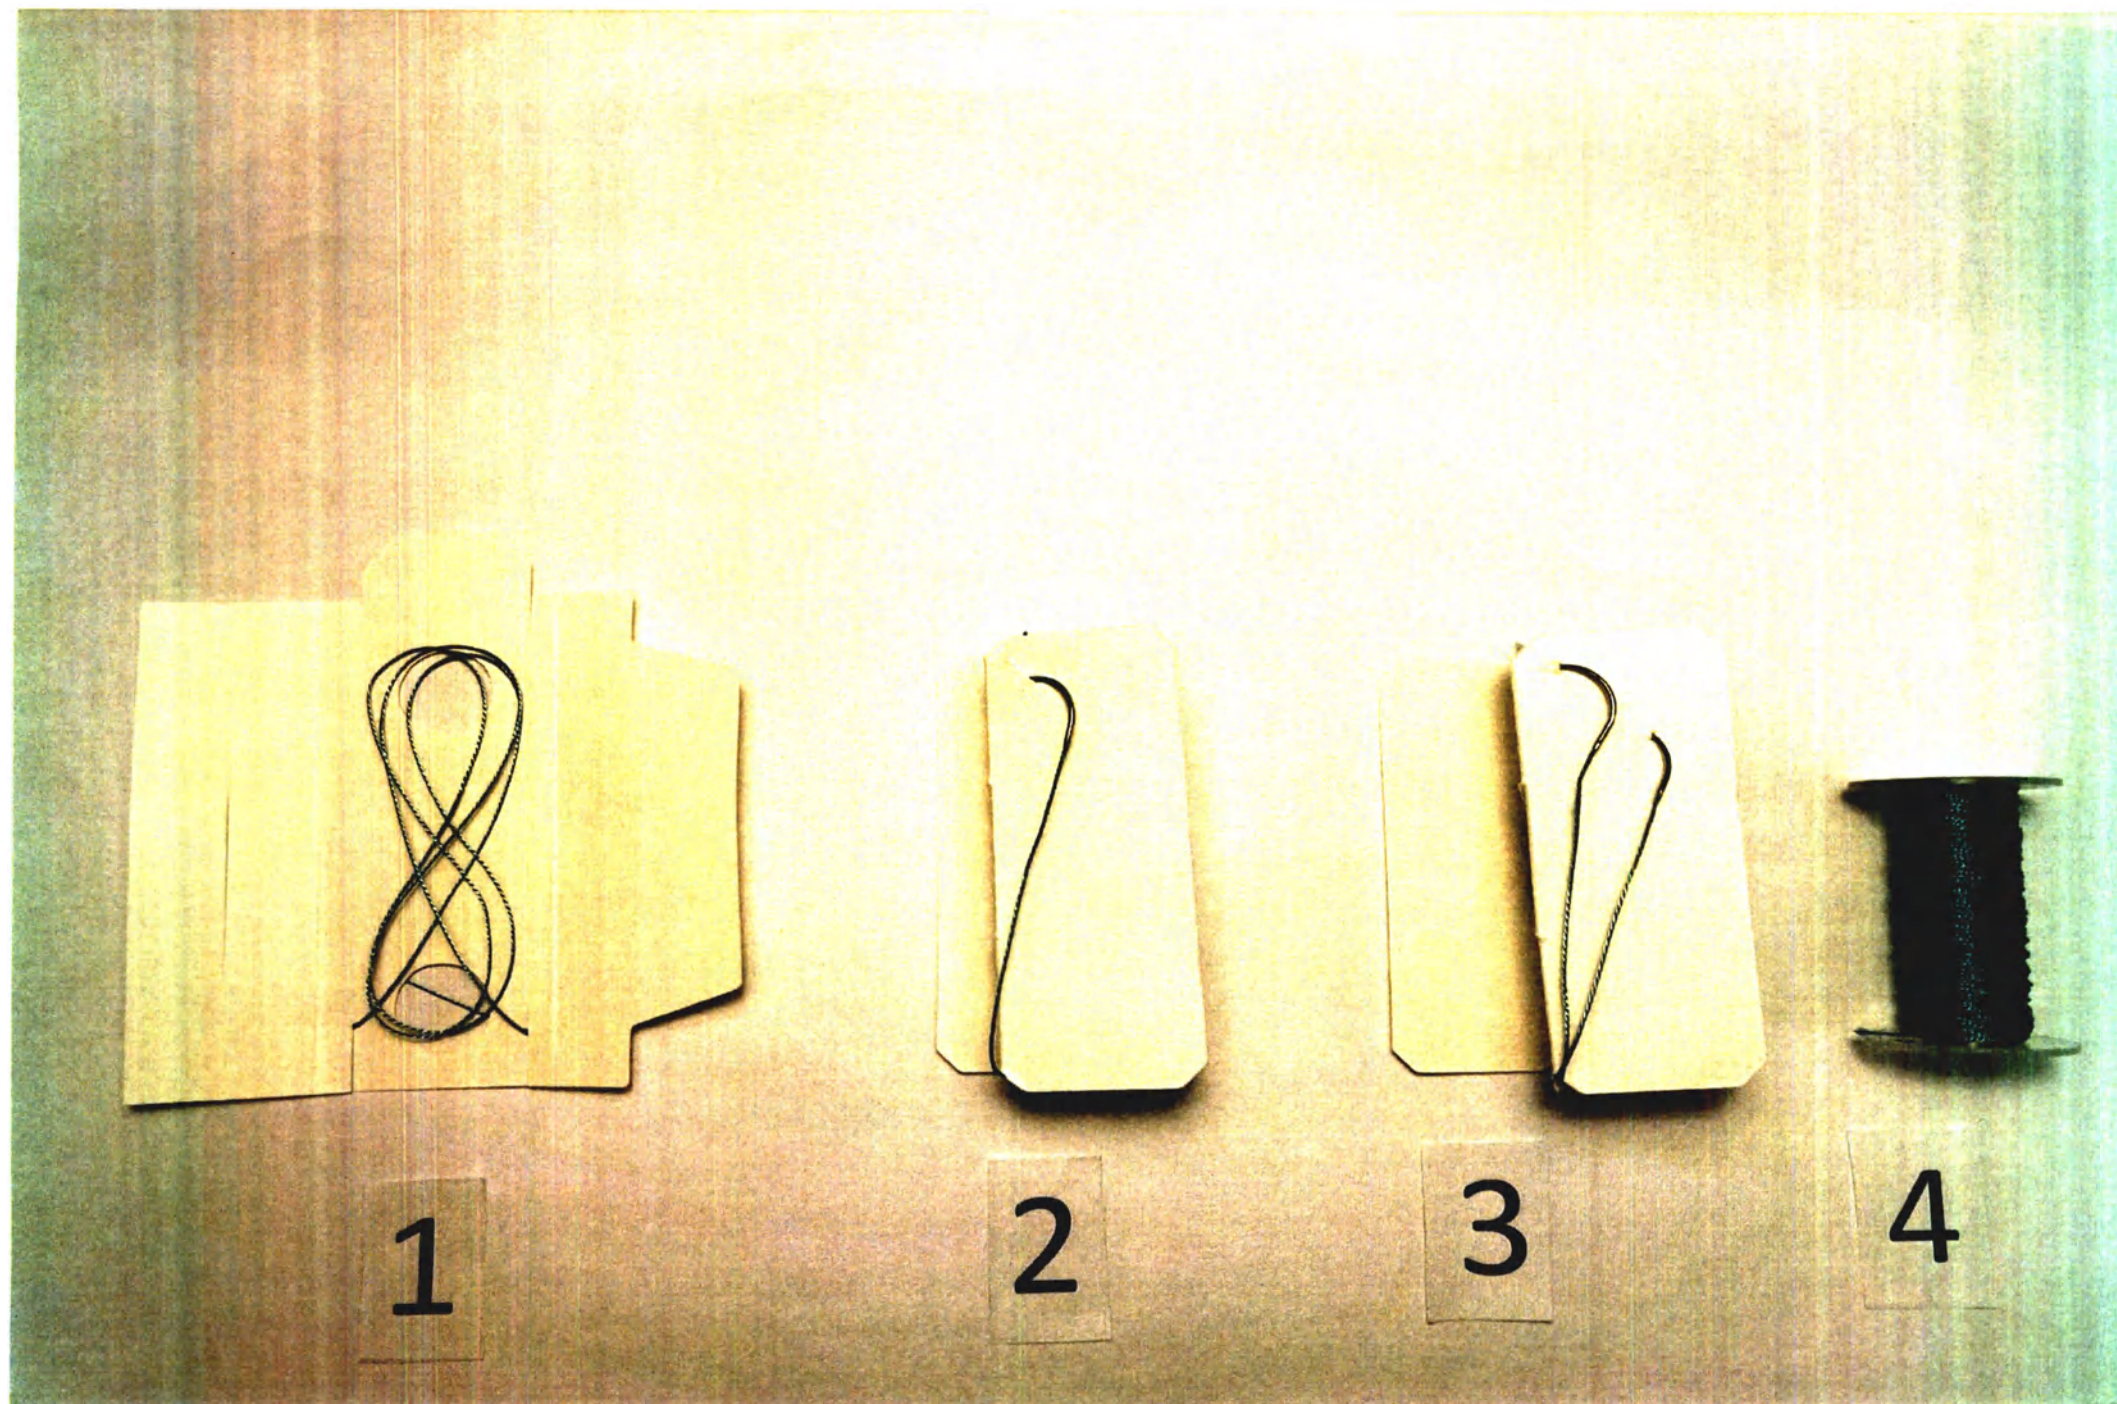


1 и 4 Нить полиэфирная крученая с силиконовым покрытием окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4- на катушке)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU с силиконовым покрытием окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

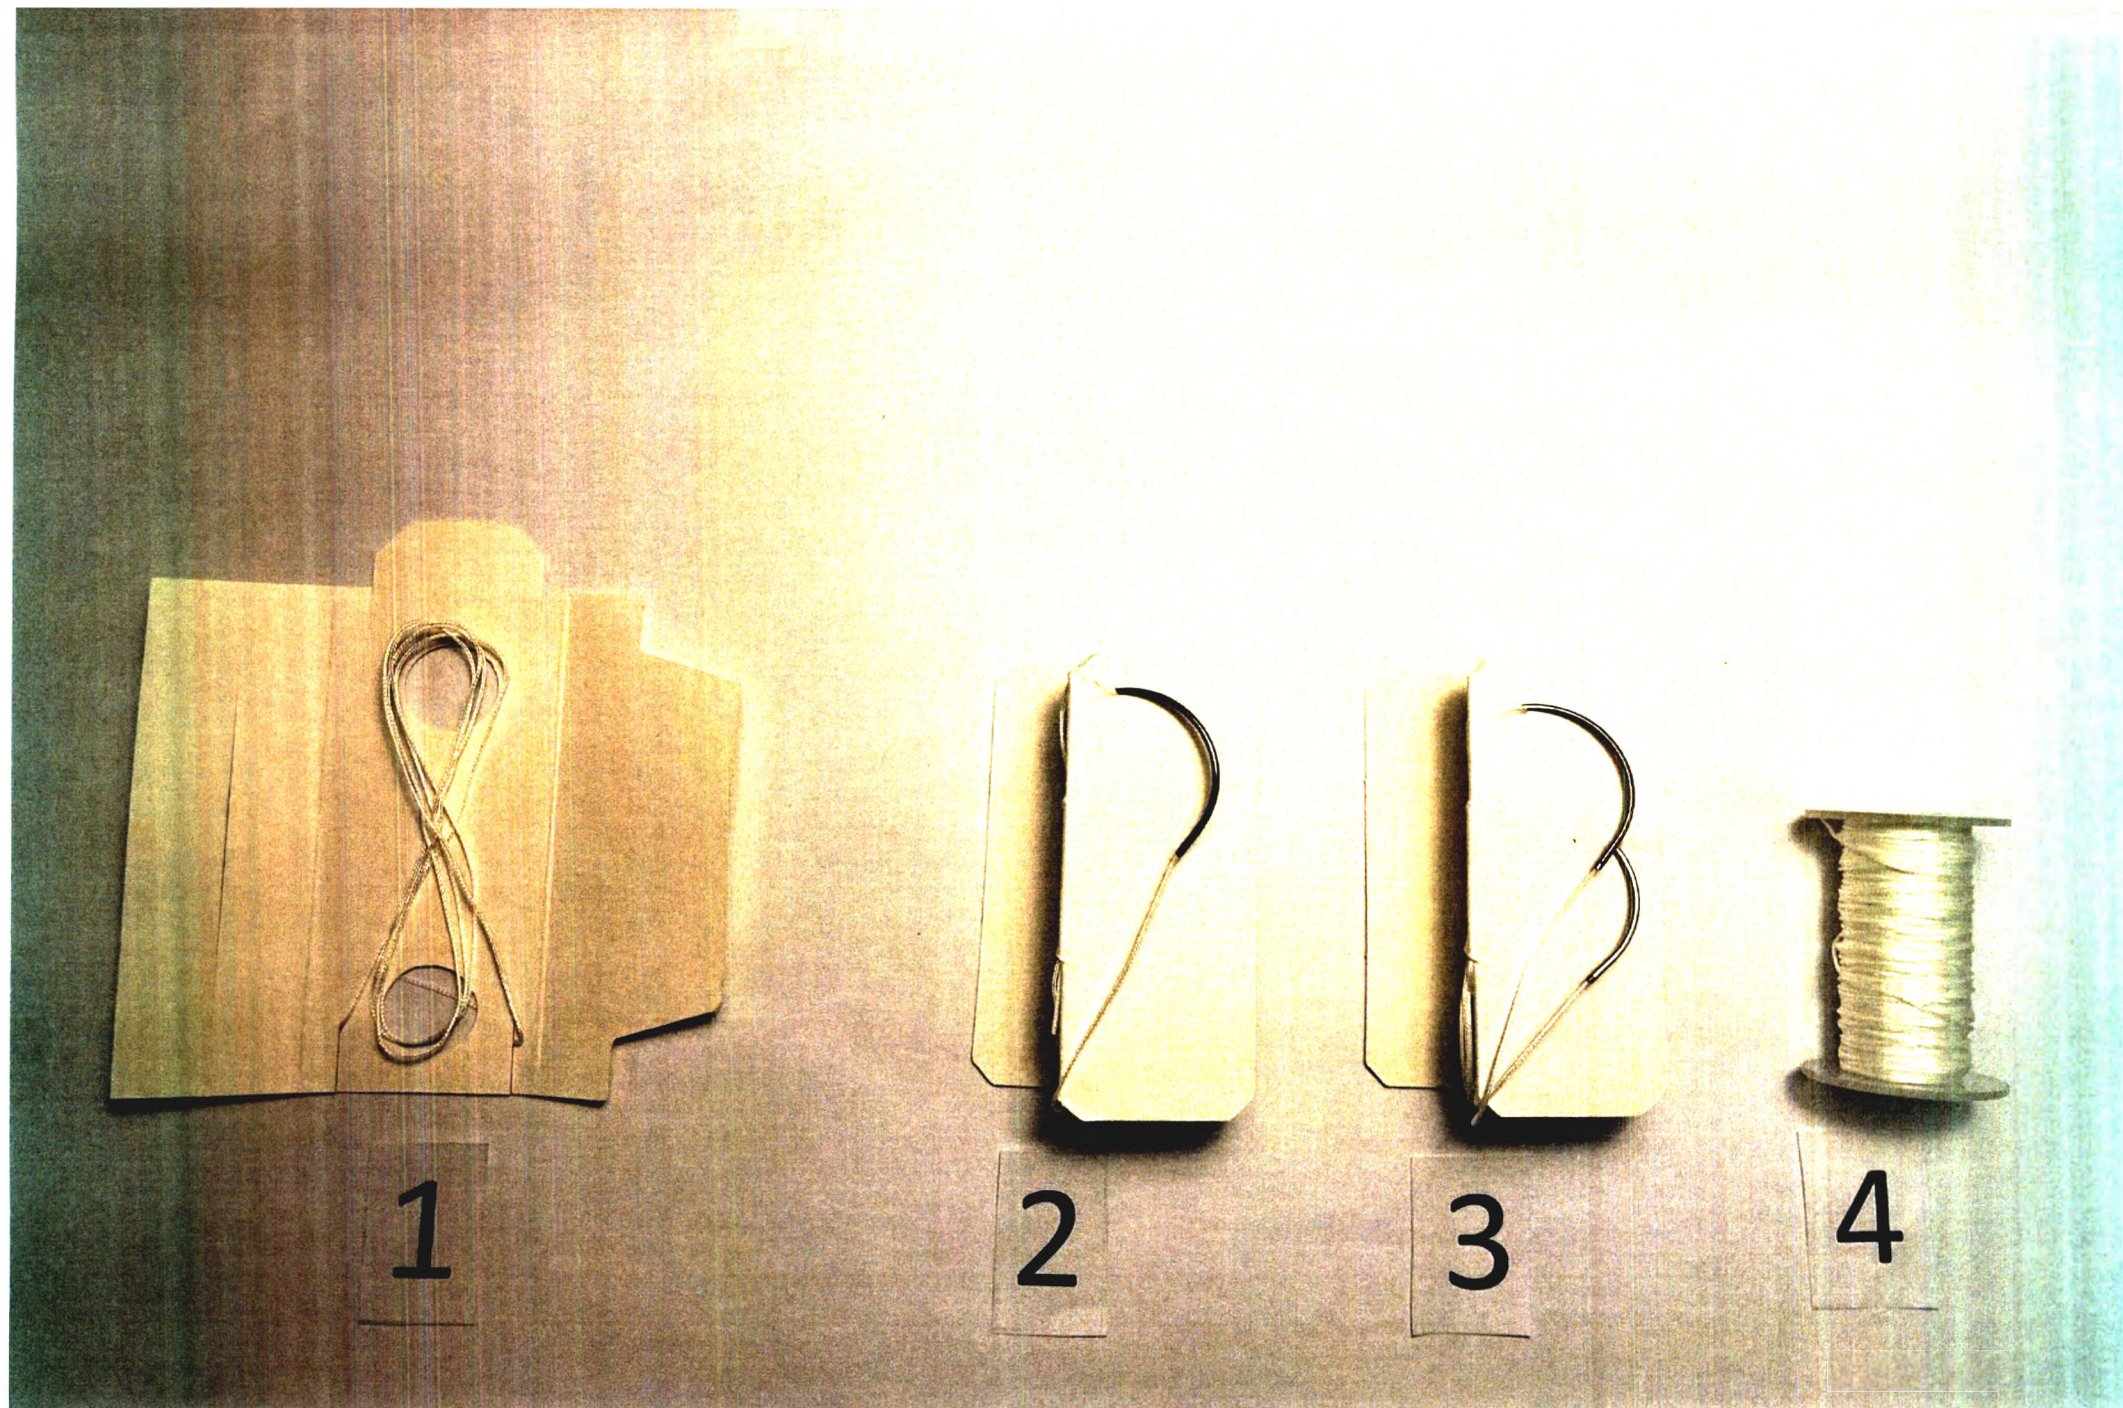

1 и 4 Нить полиэфирная плетеная неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4- на катушке)

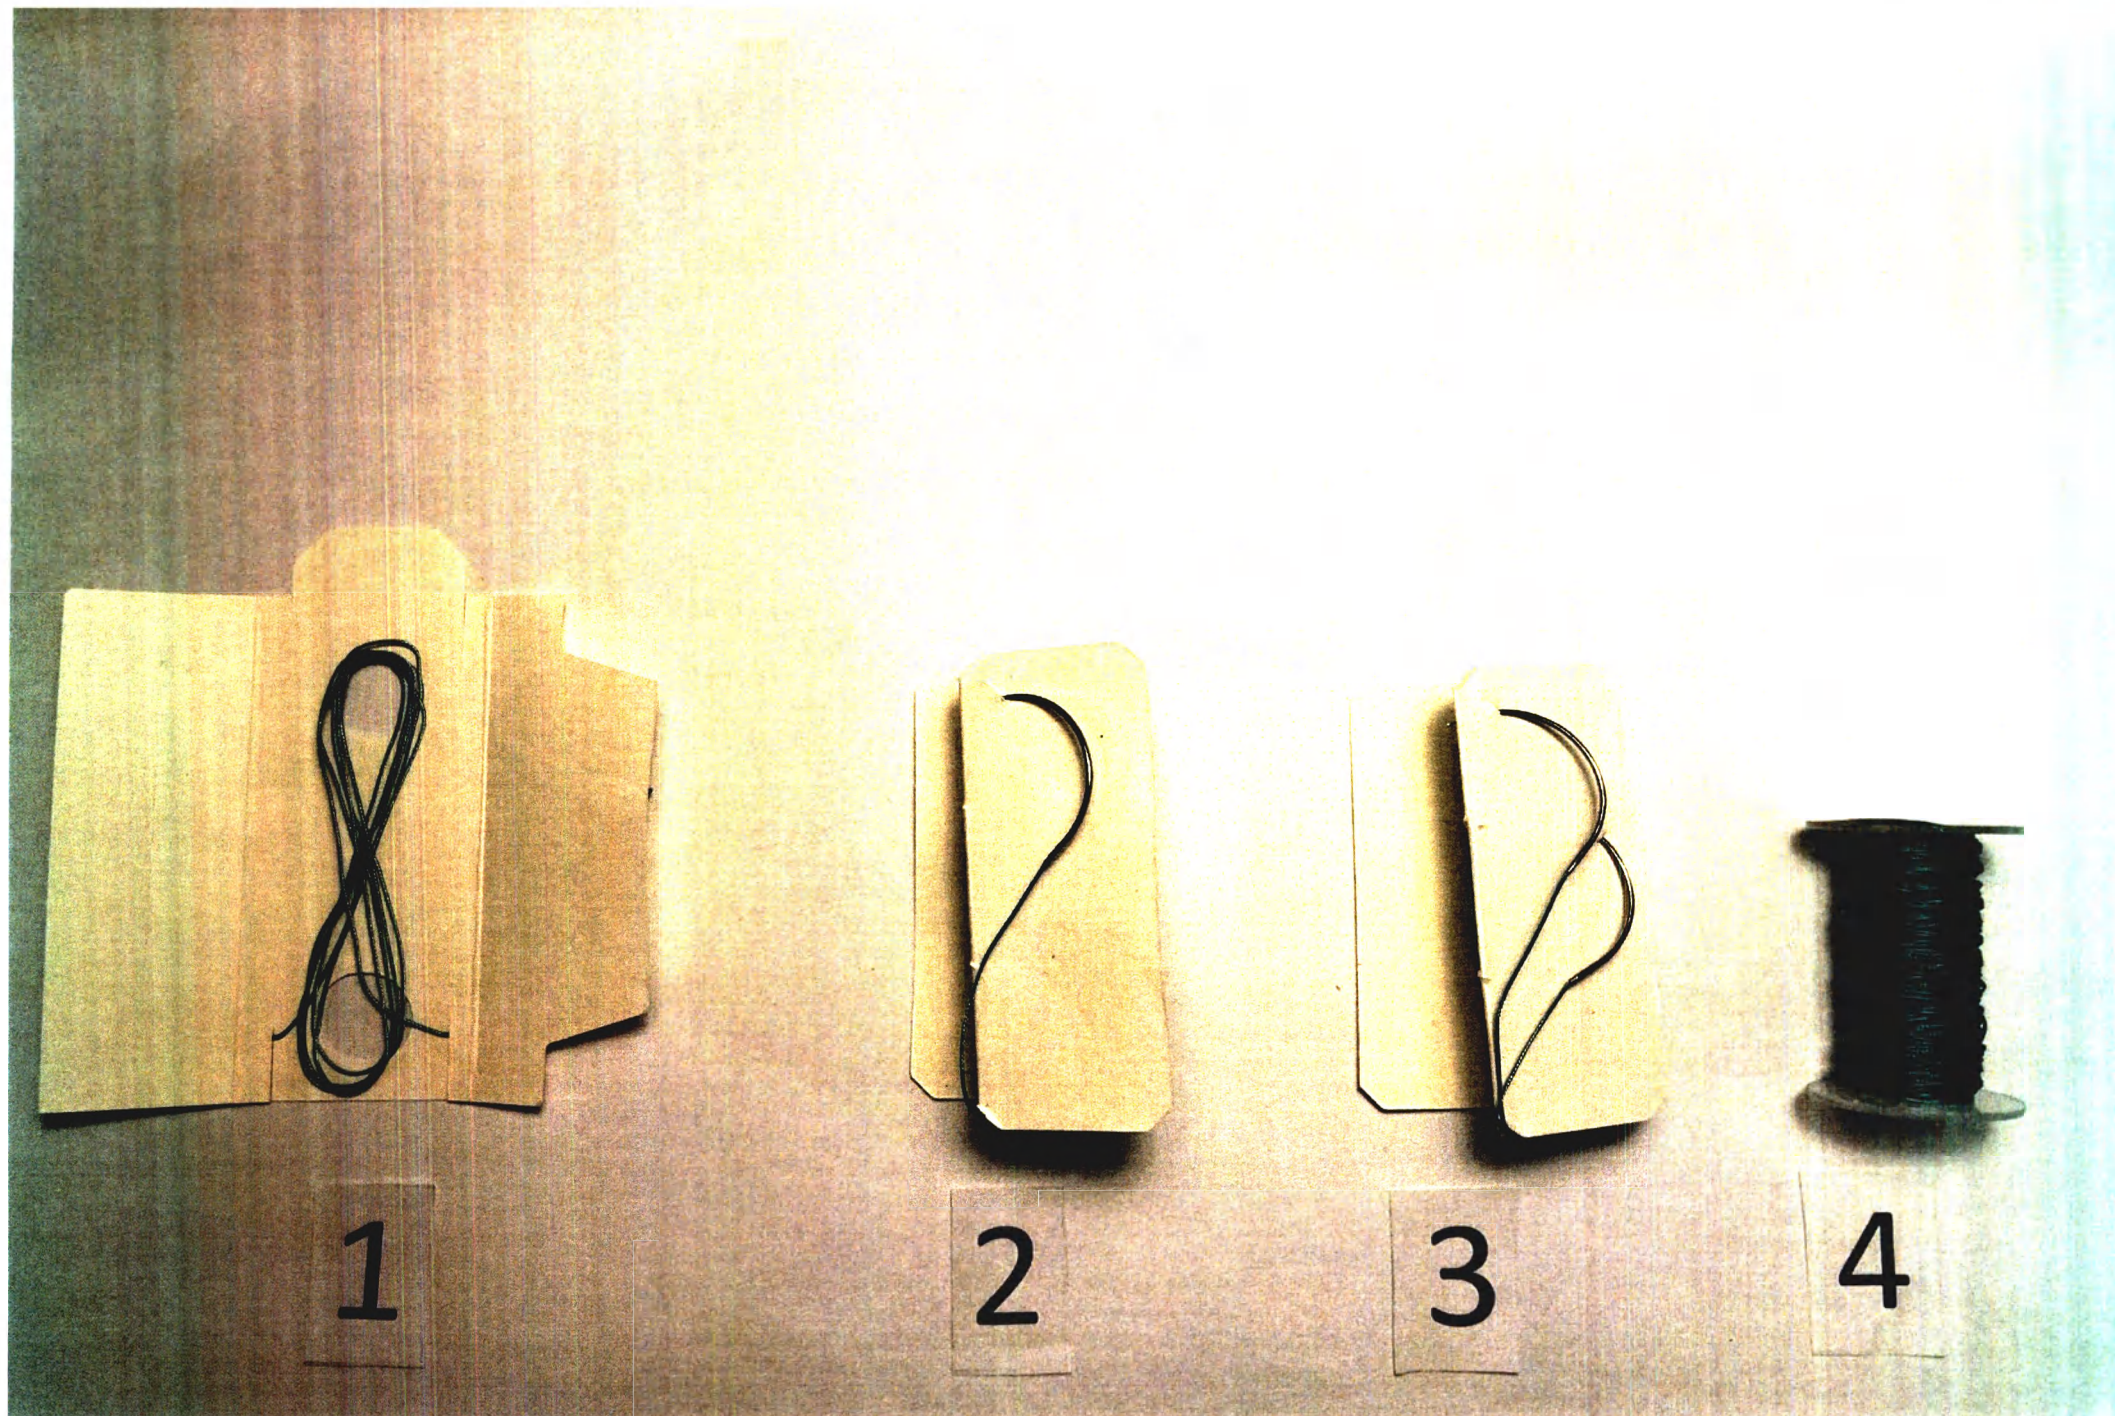


1

2

3

4

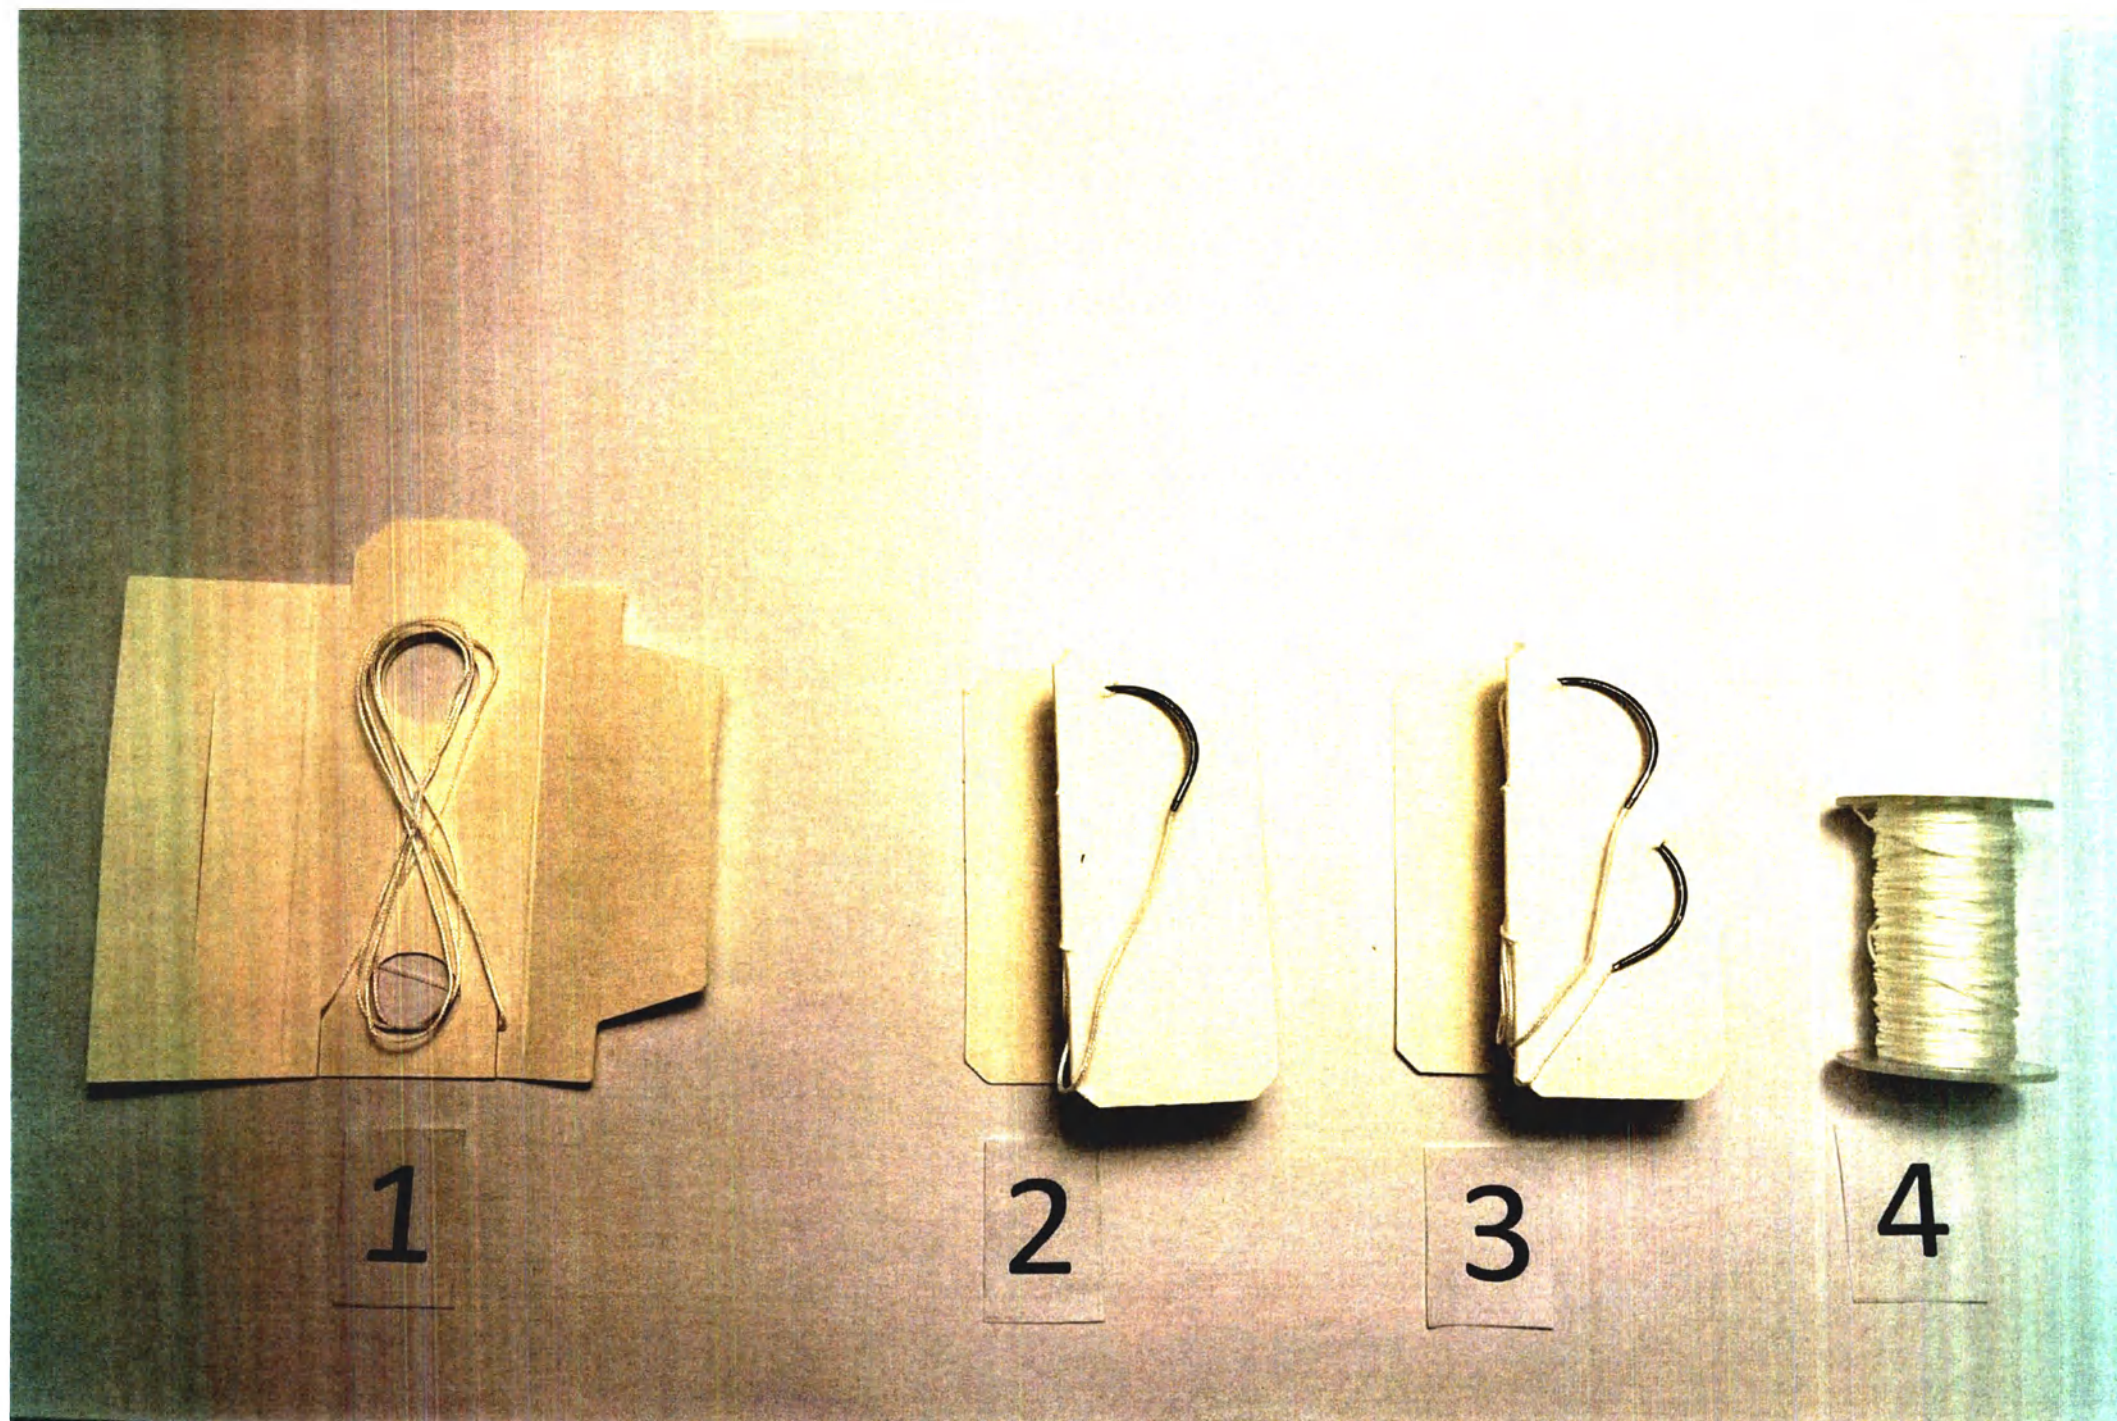

1


2

3

4

1 и 4 Нить полиэфирная плетеная с фторполимерным покрытием неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4- на катушке)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU с фторполимерным покрытием неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

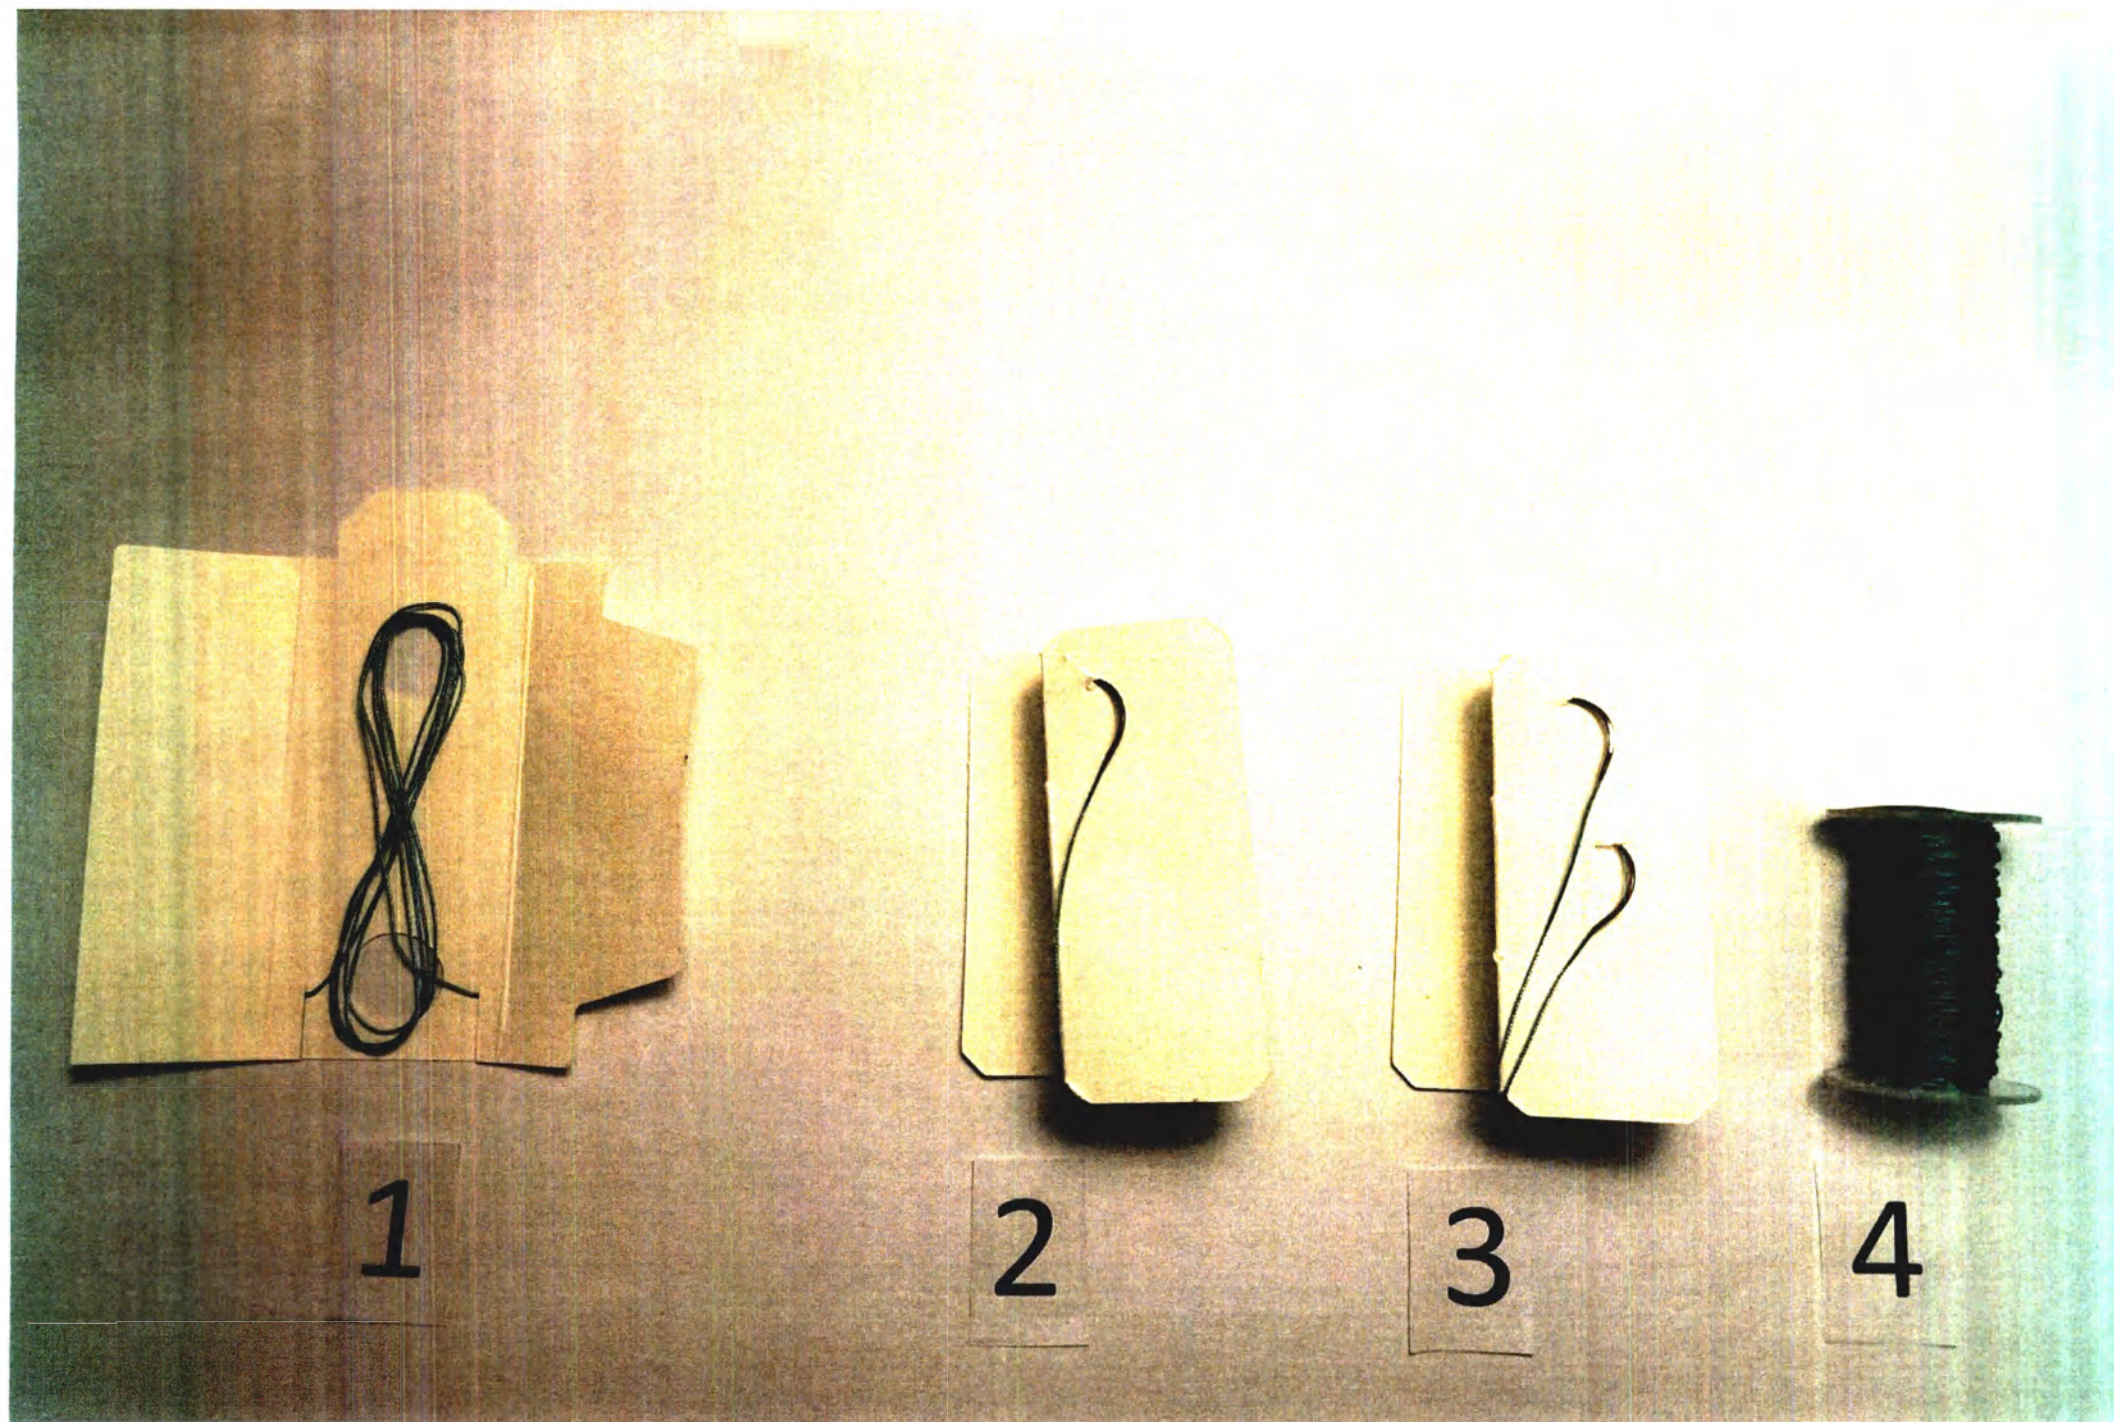


1

2


3

4

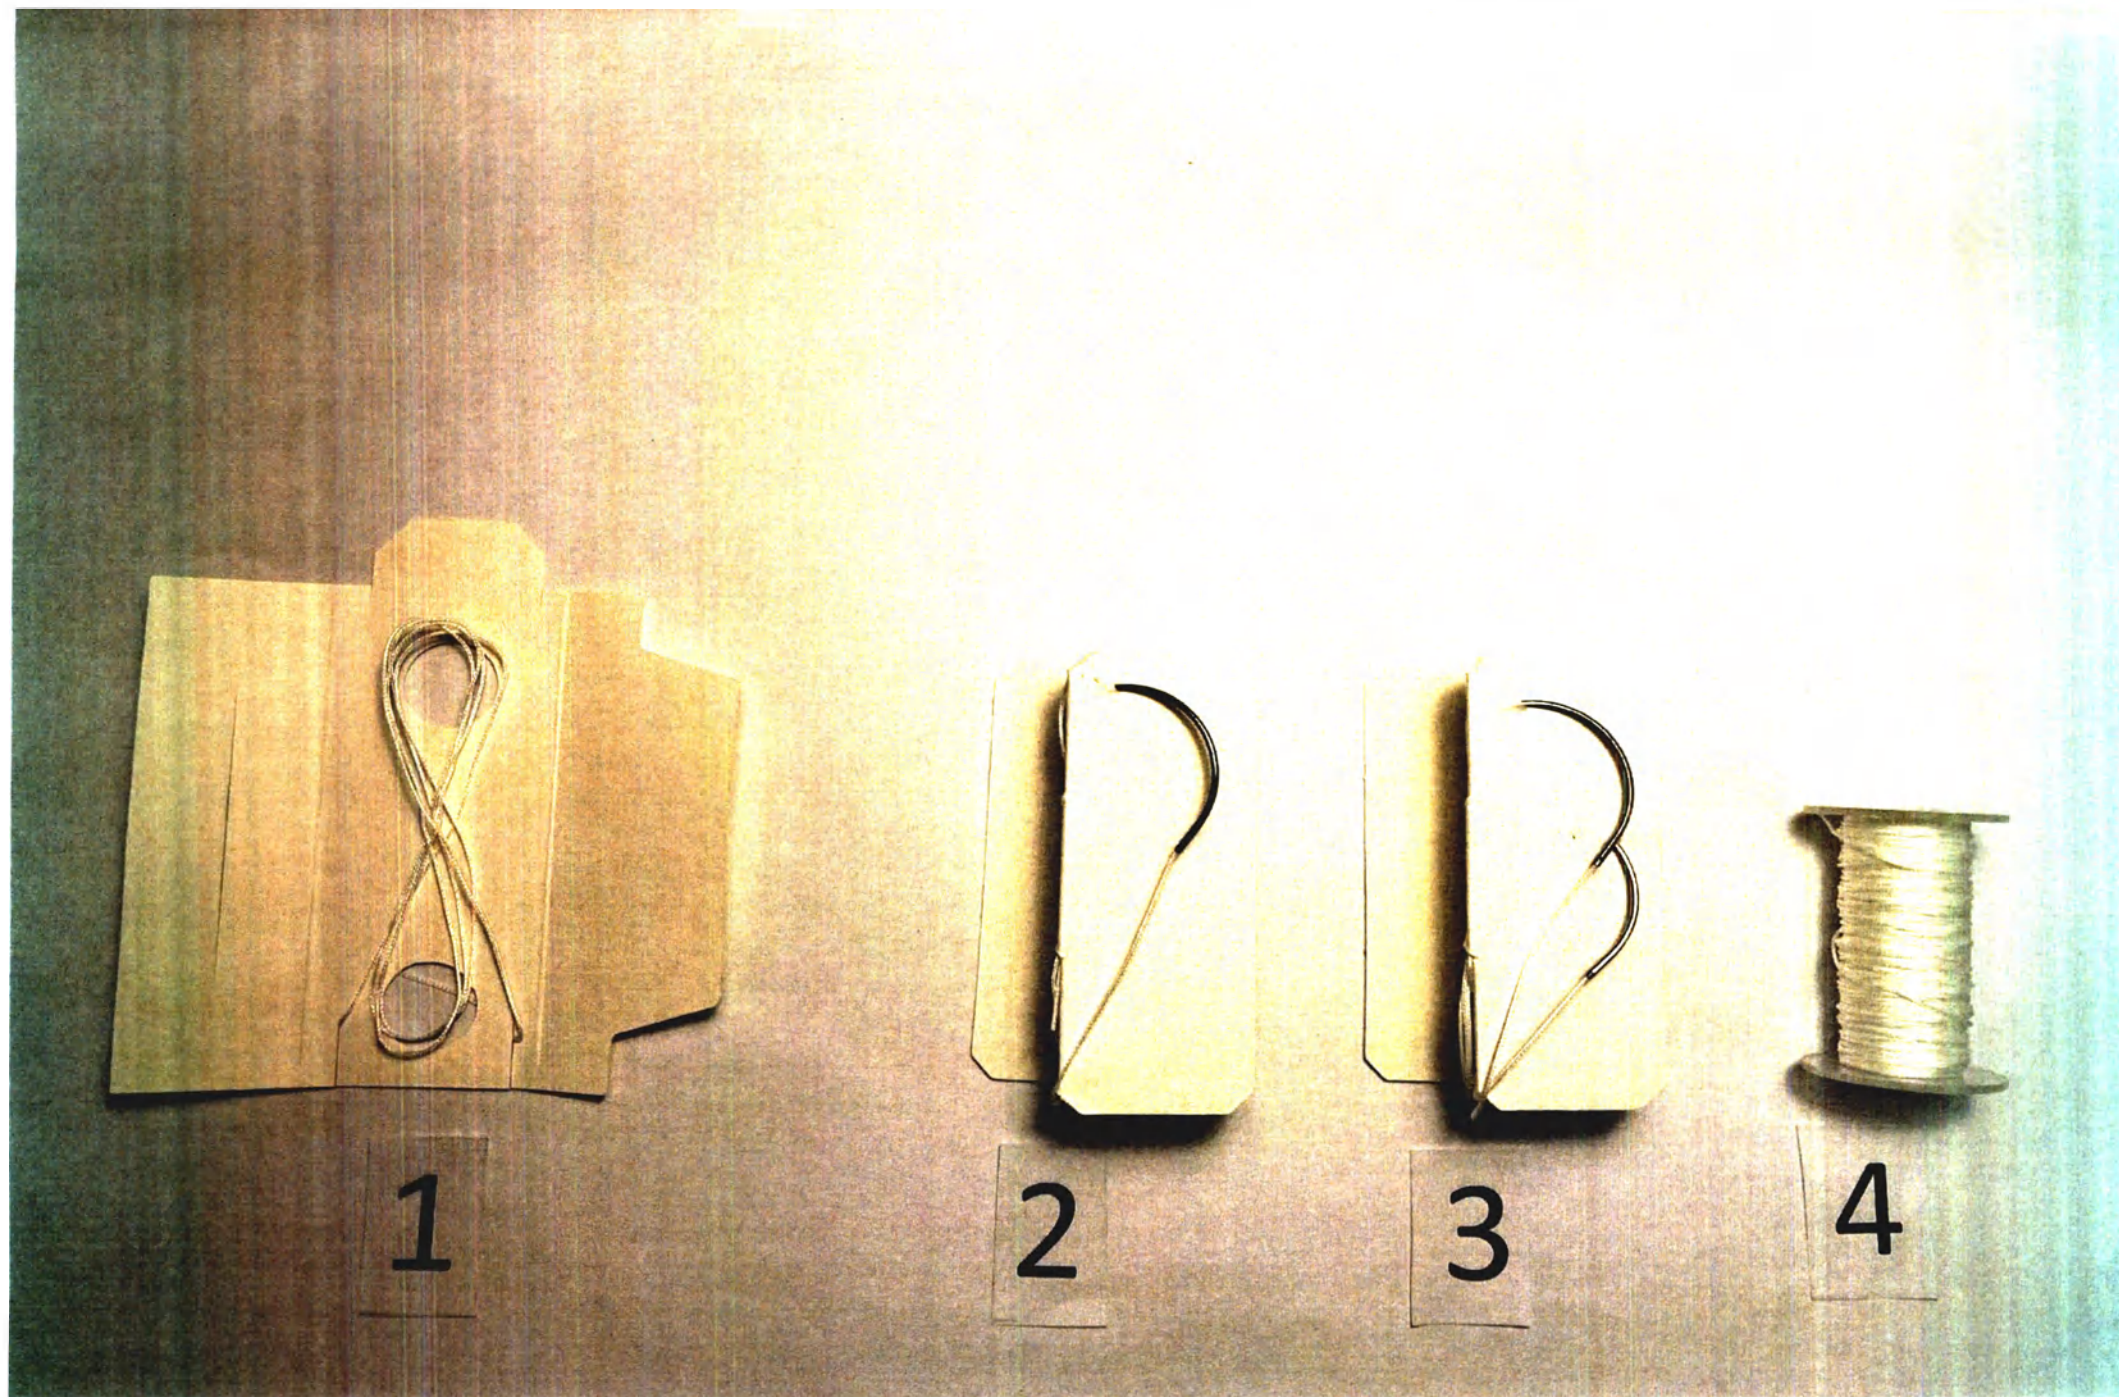


1 и 4 Нить полиэфирная плетеная с силиконовым покрытием неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4- на катушке)

2 и 3 Нить полиэфирная плетеная с силиконовым покрытием неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

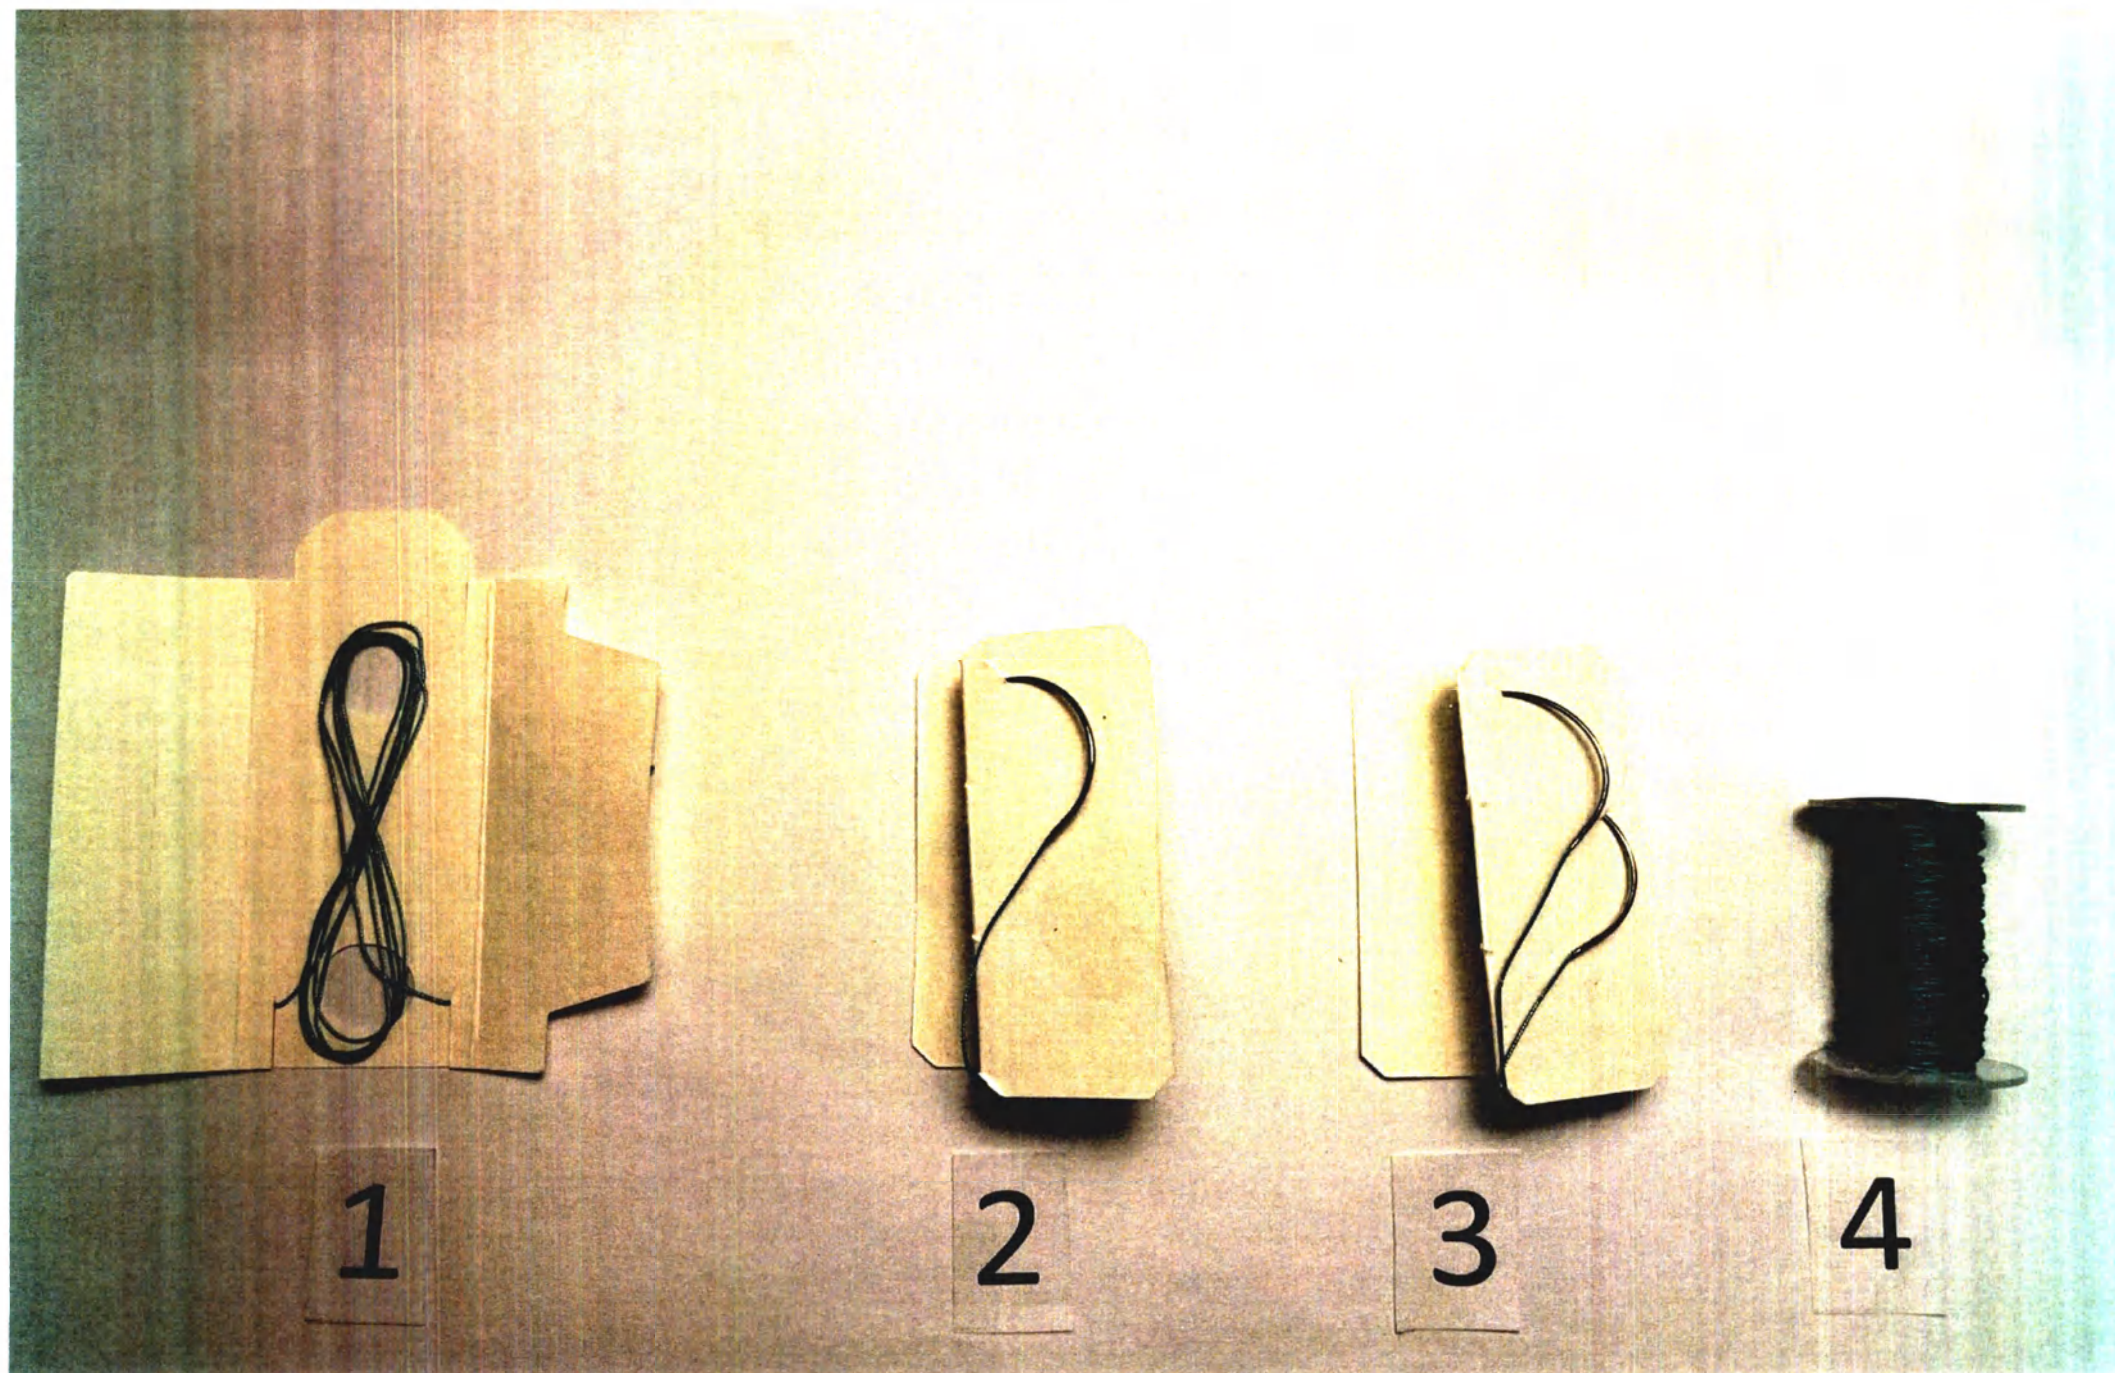


1 и 4 Нить полиэфирная плетеная с силиконовым покрытием окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4- на катушке)

2 и 3 Нить полиэфирная плетеная с силиконовым покрытием окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

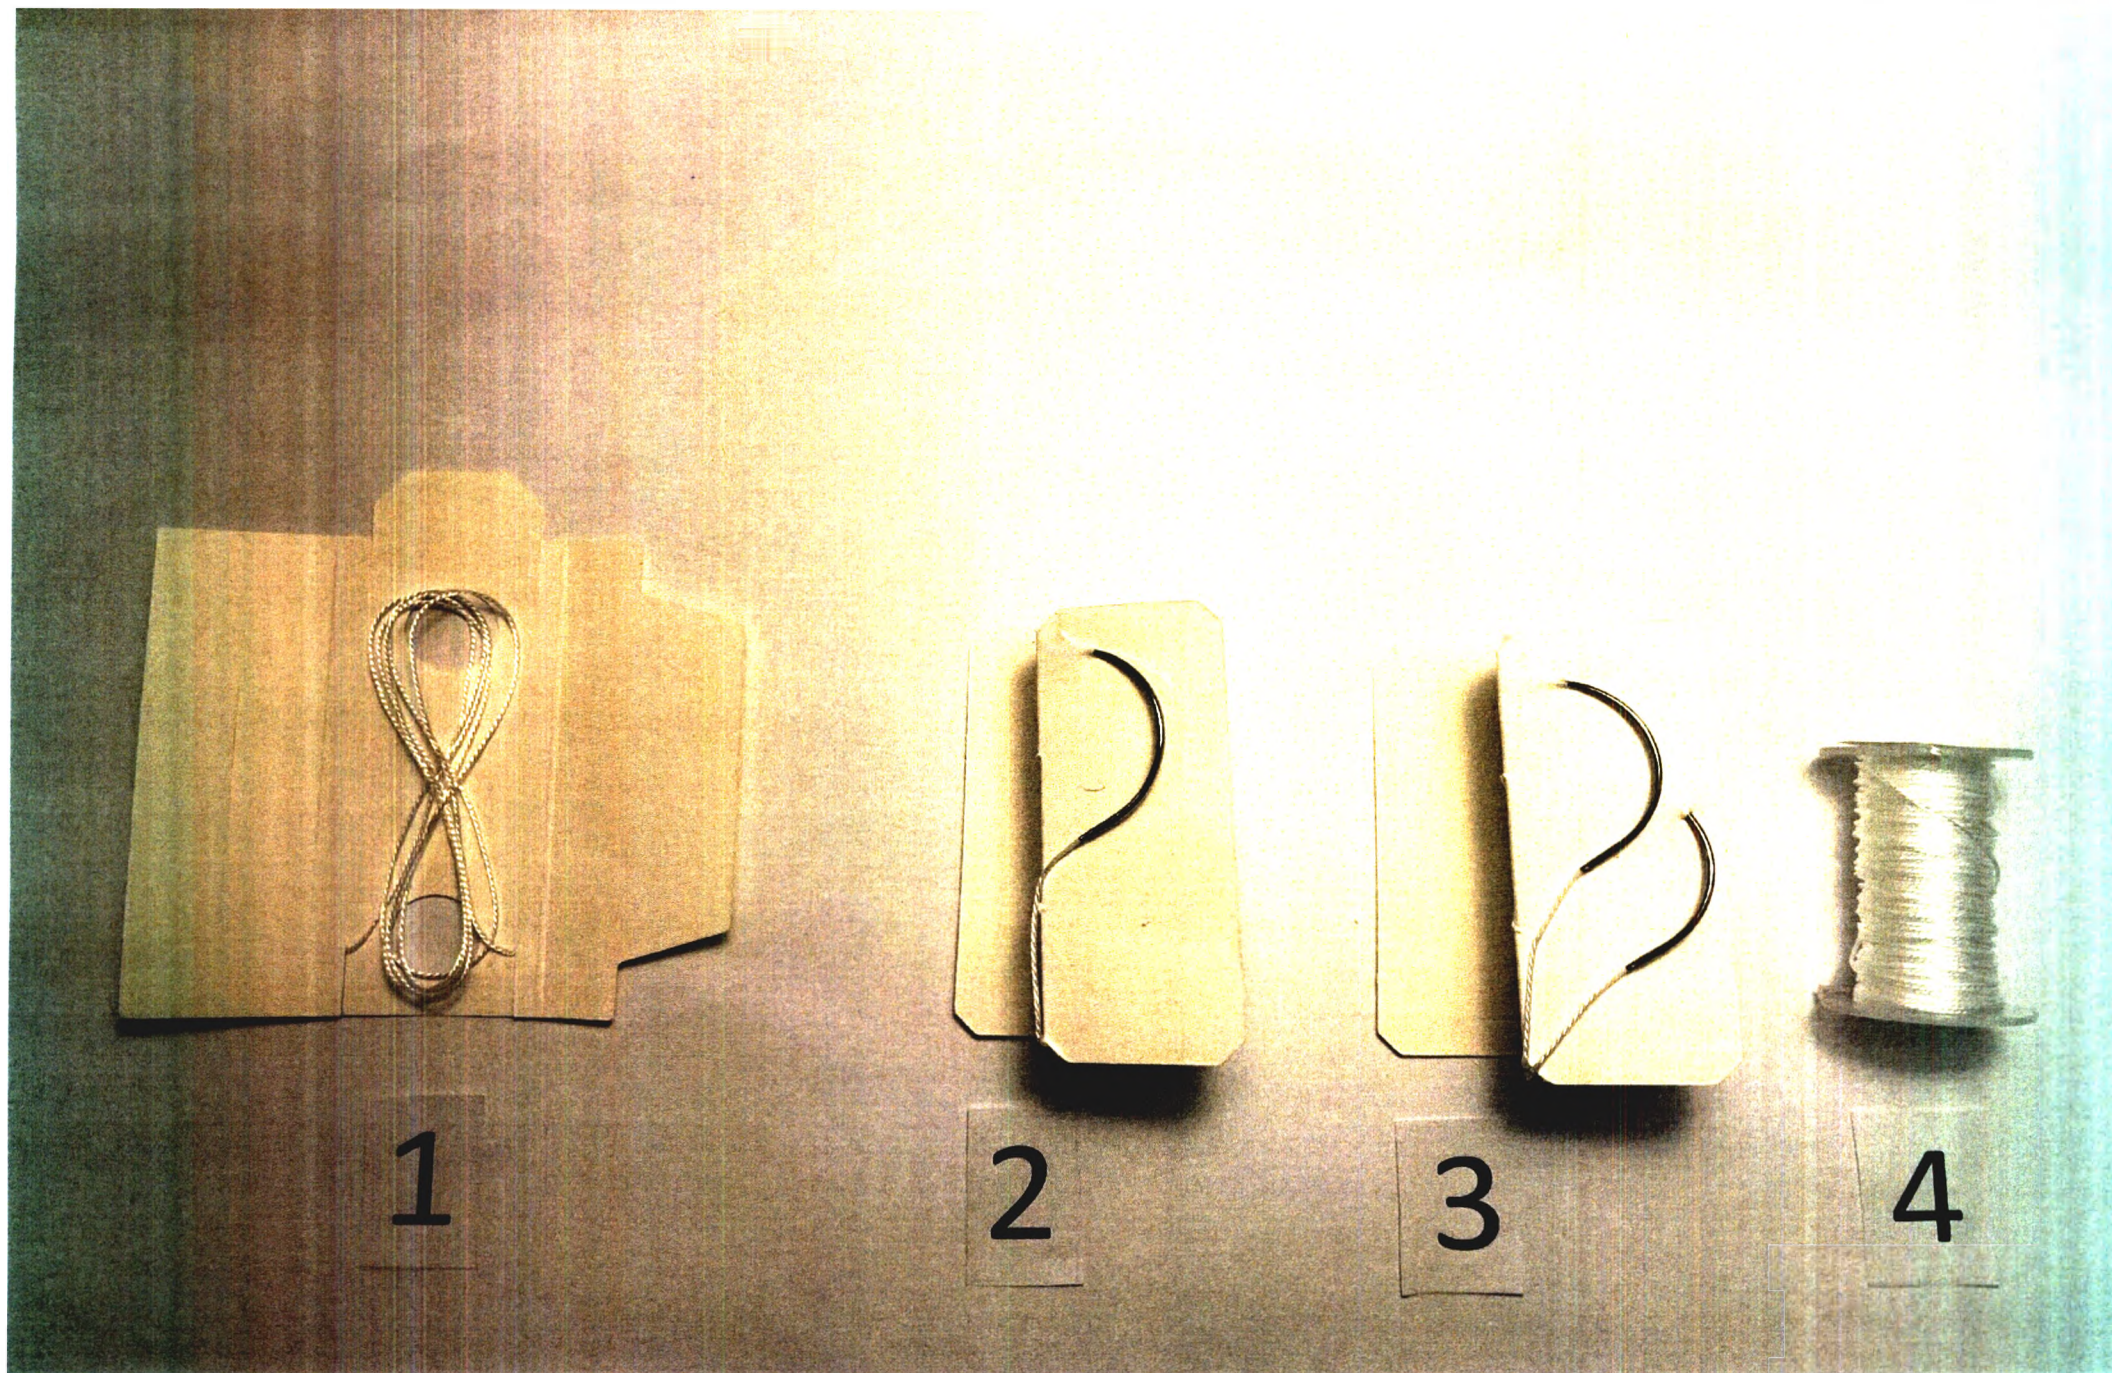


1 и 4 Нить полиамидная крученая неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4- на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная крученая неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

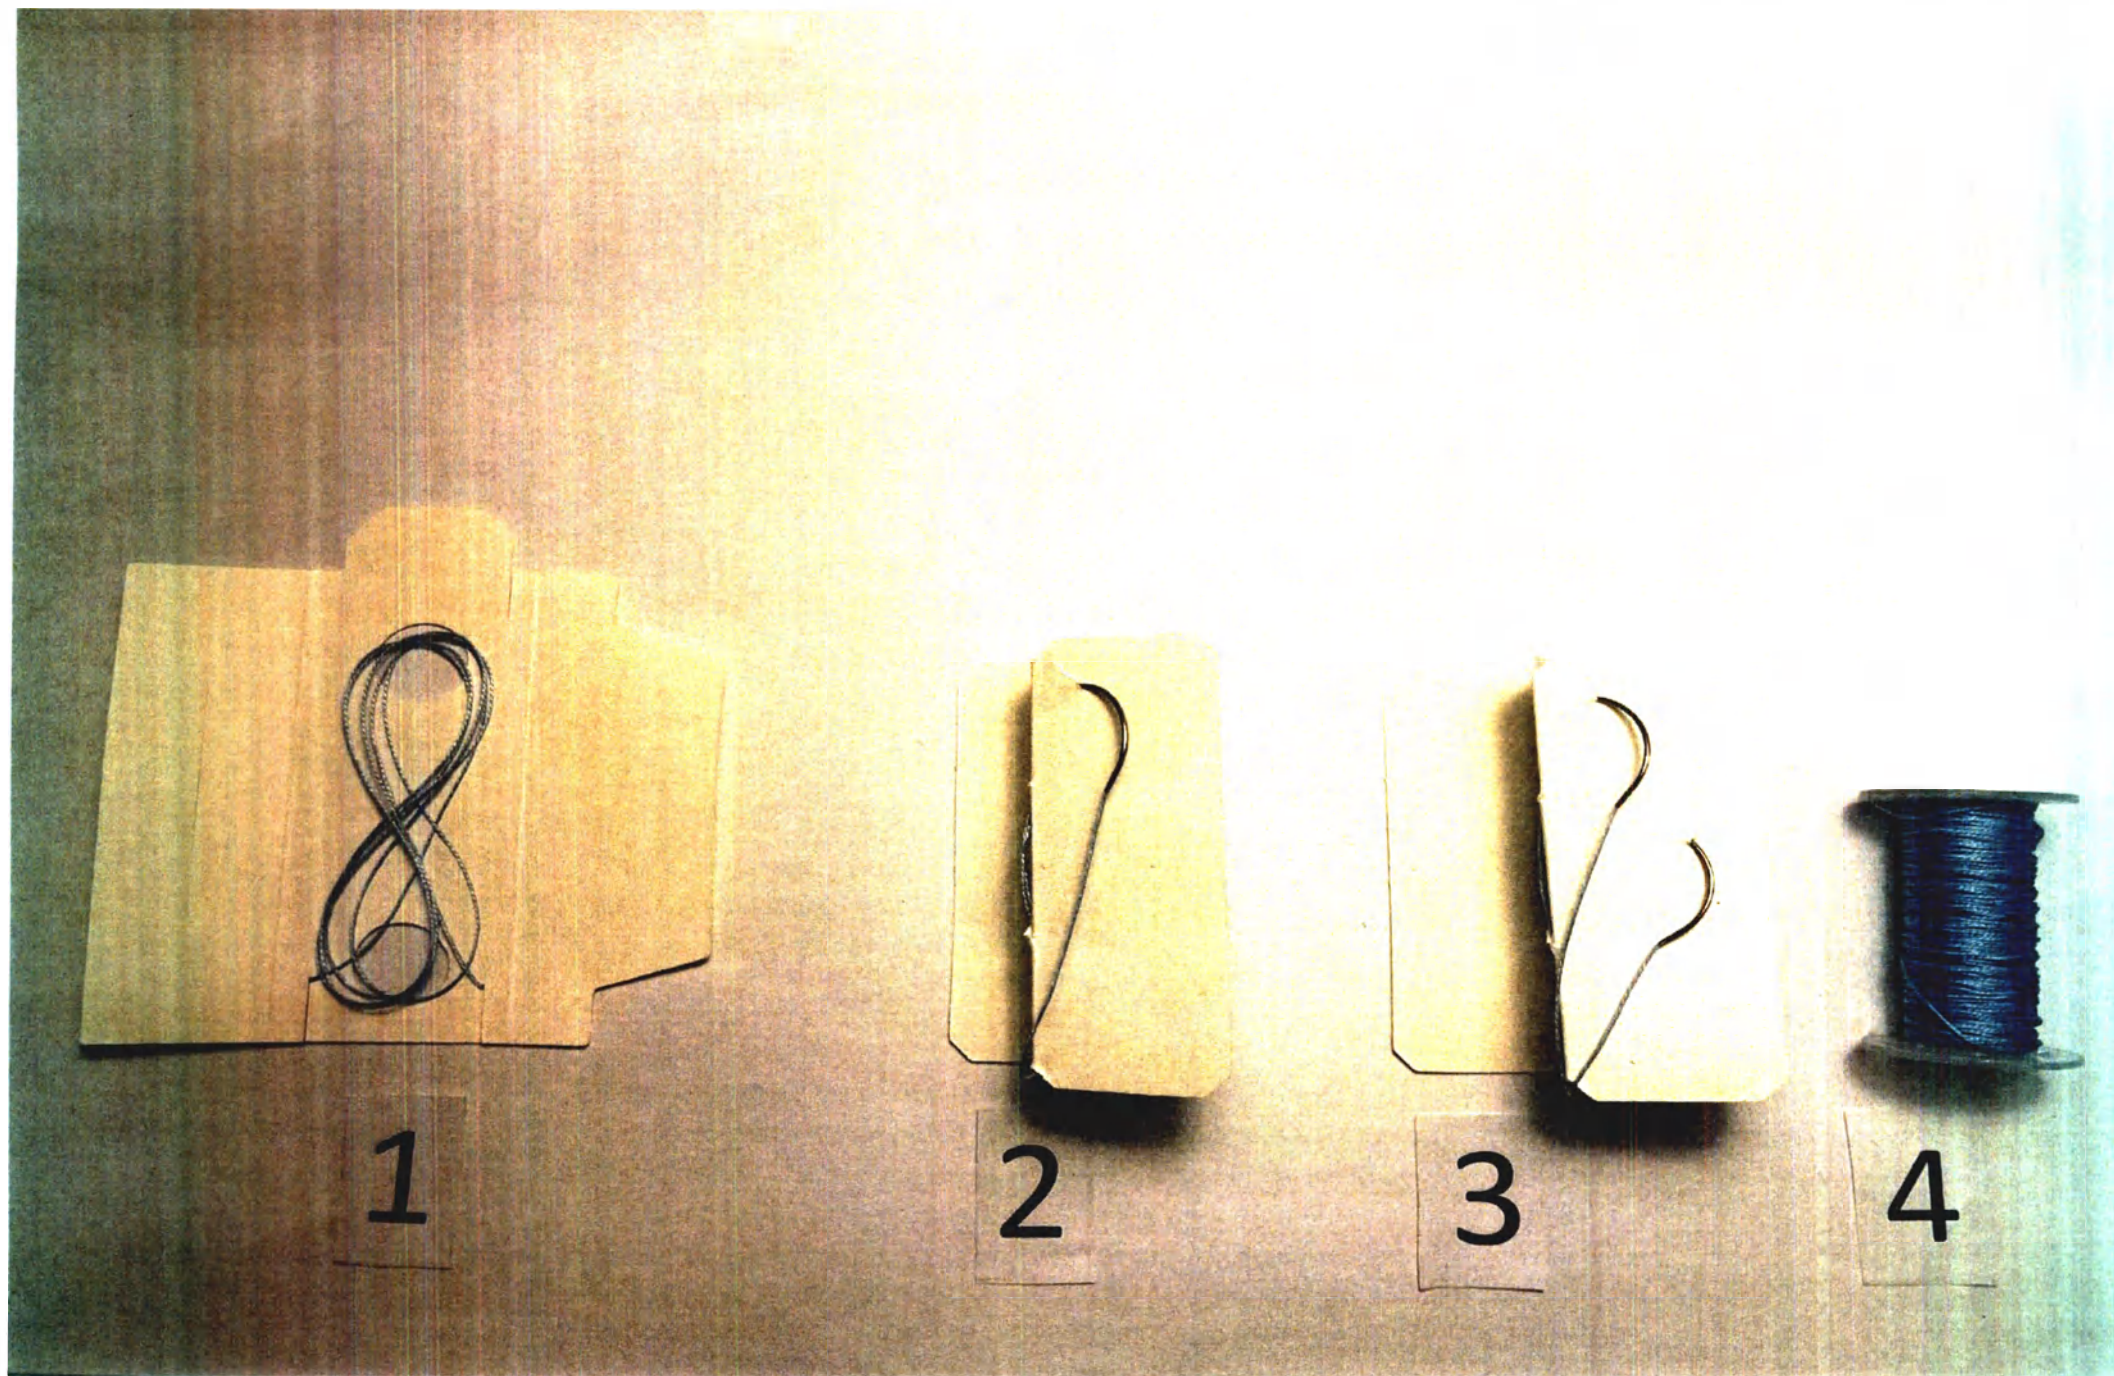


1 и 4 Нить полиамидная крученная окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1-в отрезке, 4- на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная крученная окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

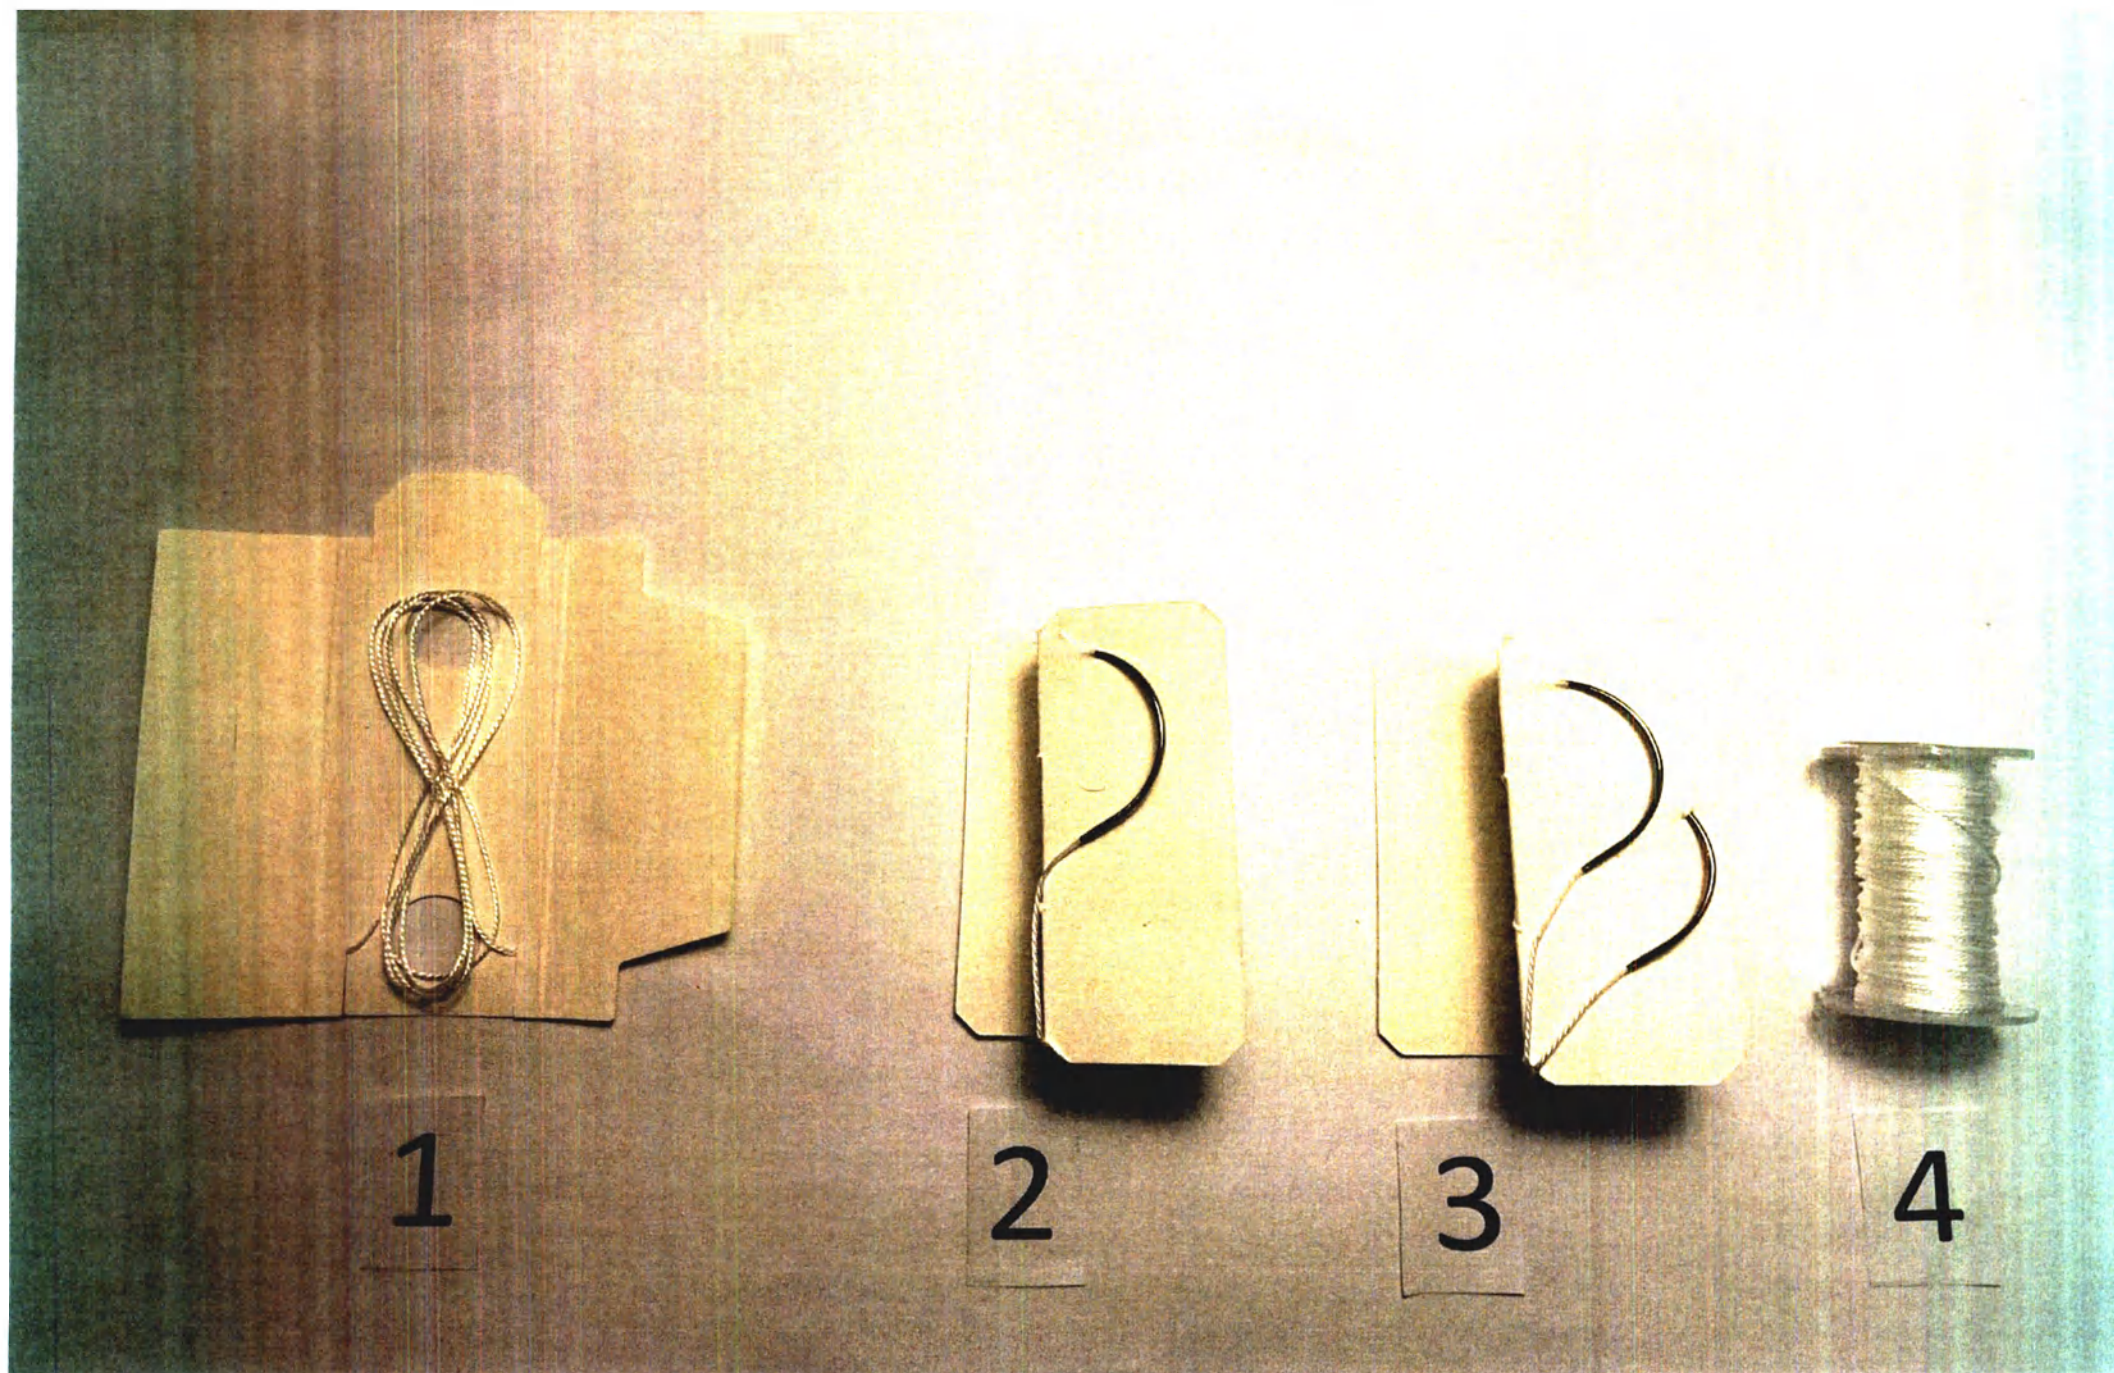


1 и 4 Нить полиамидная крученая с фторполимерным покрытием неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная крученая с фторполимерным покрытием неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

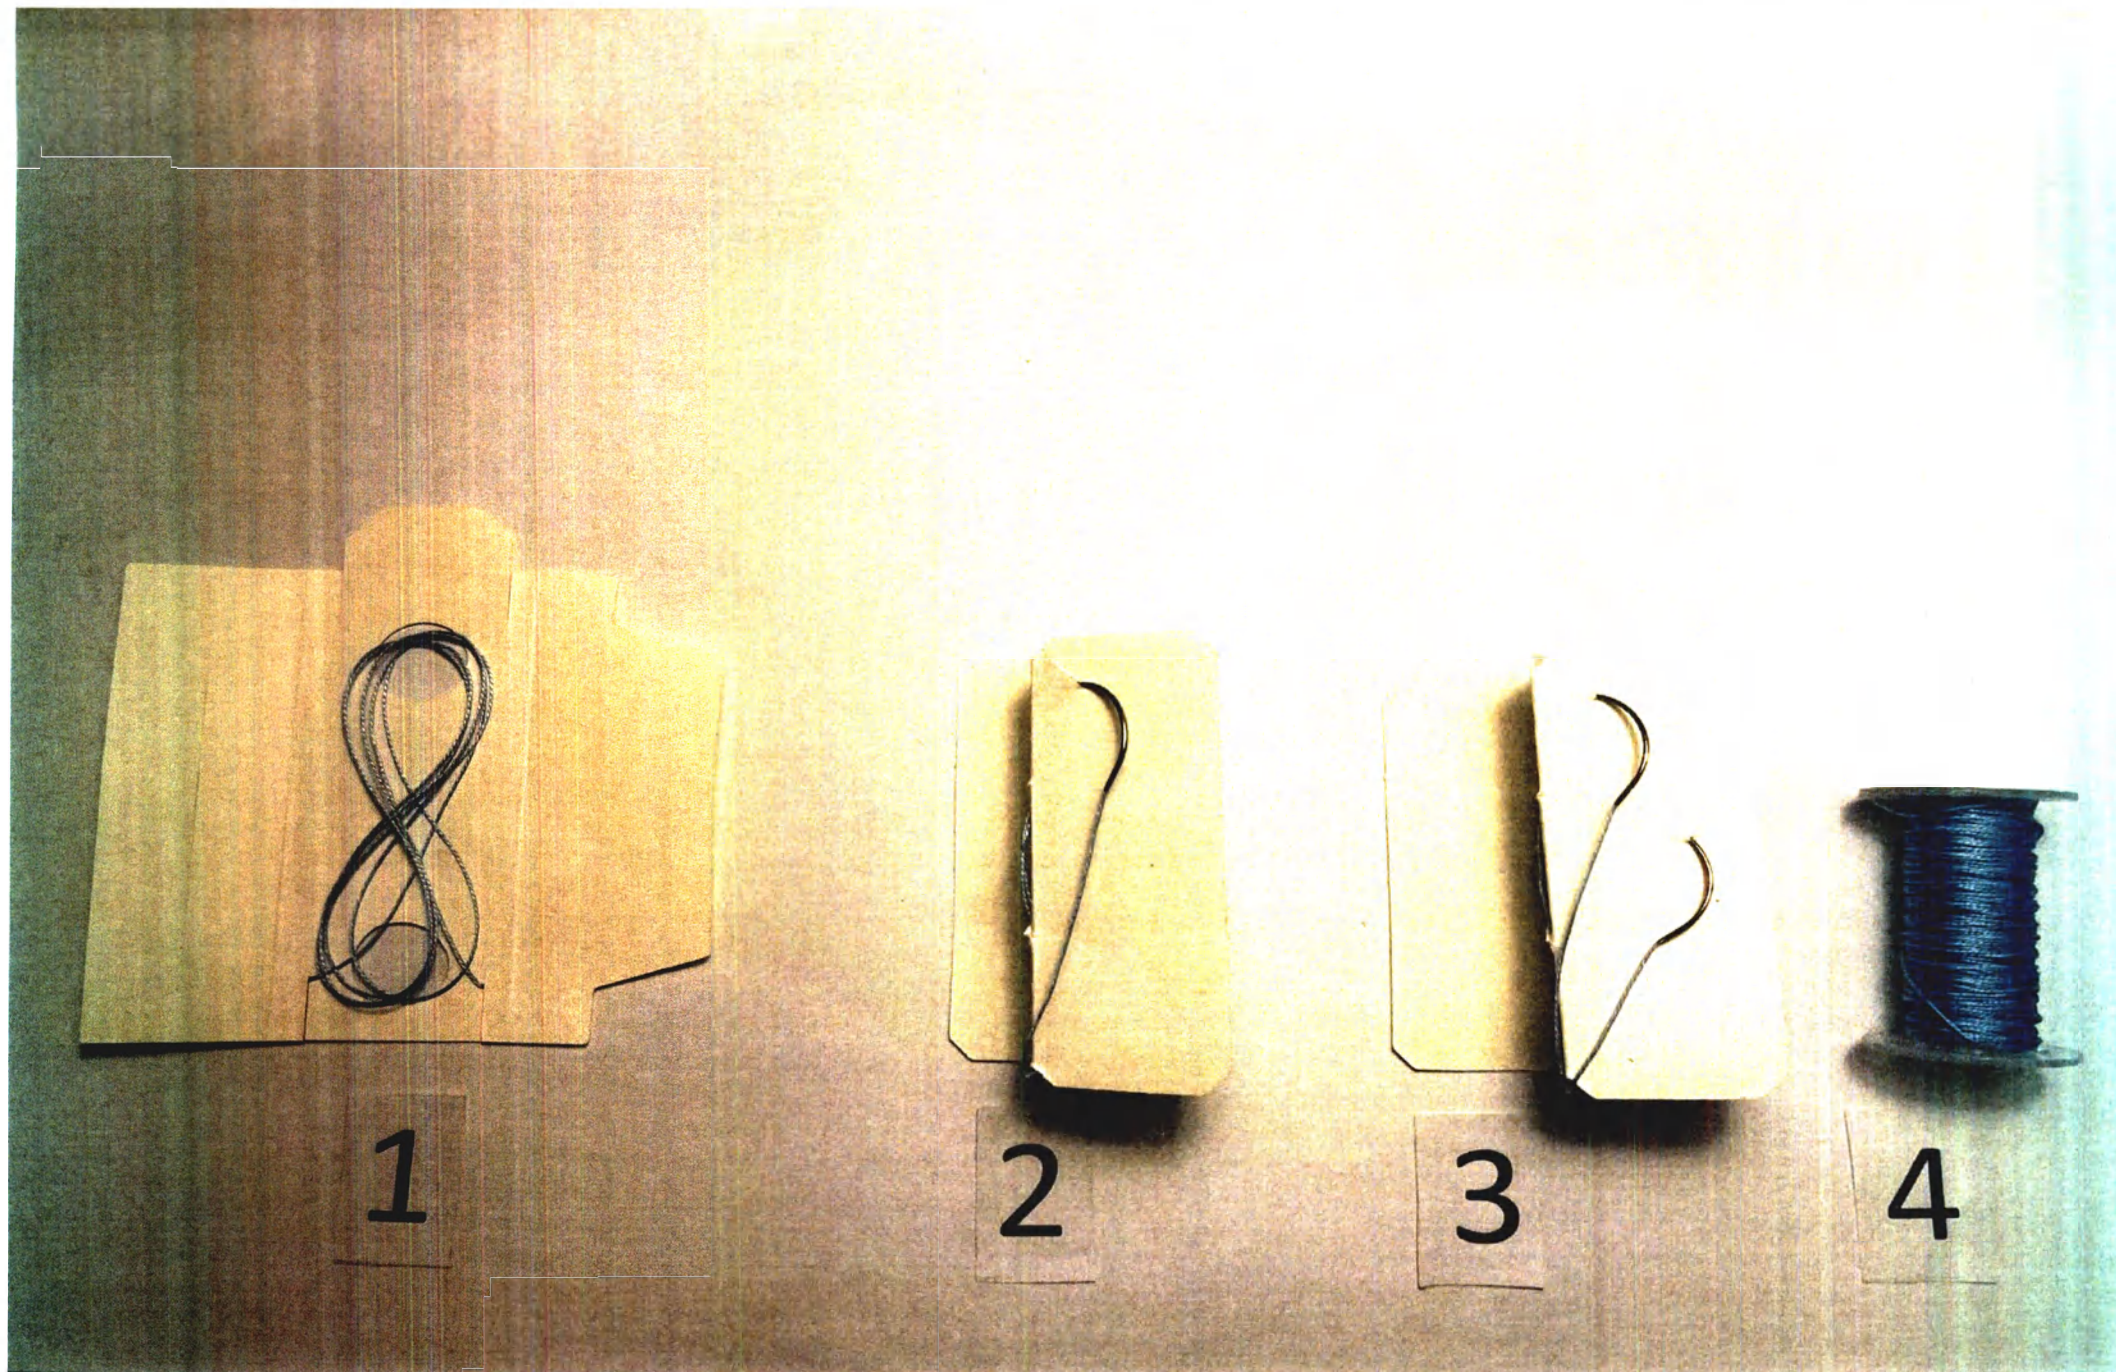


1 и 4 Нить полиамидная крученная с фторполимерным покрытием окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная крученная с фторполимерным покрытием окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

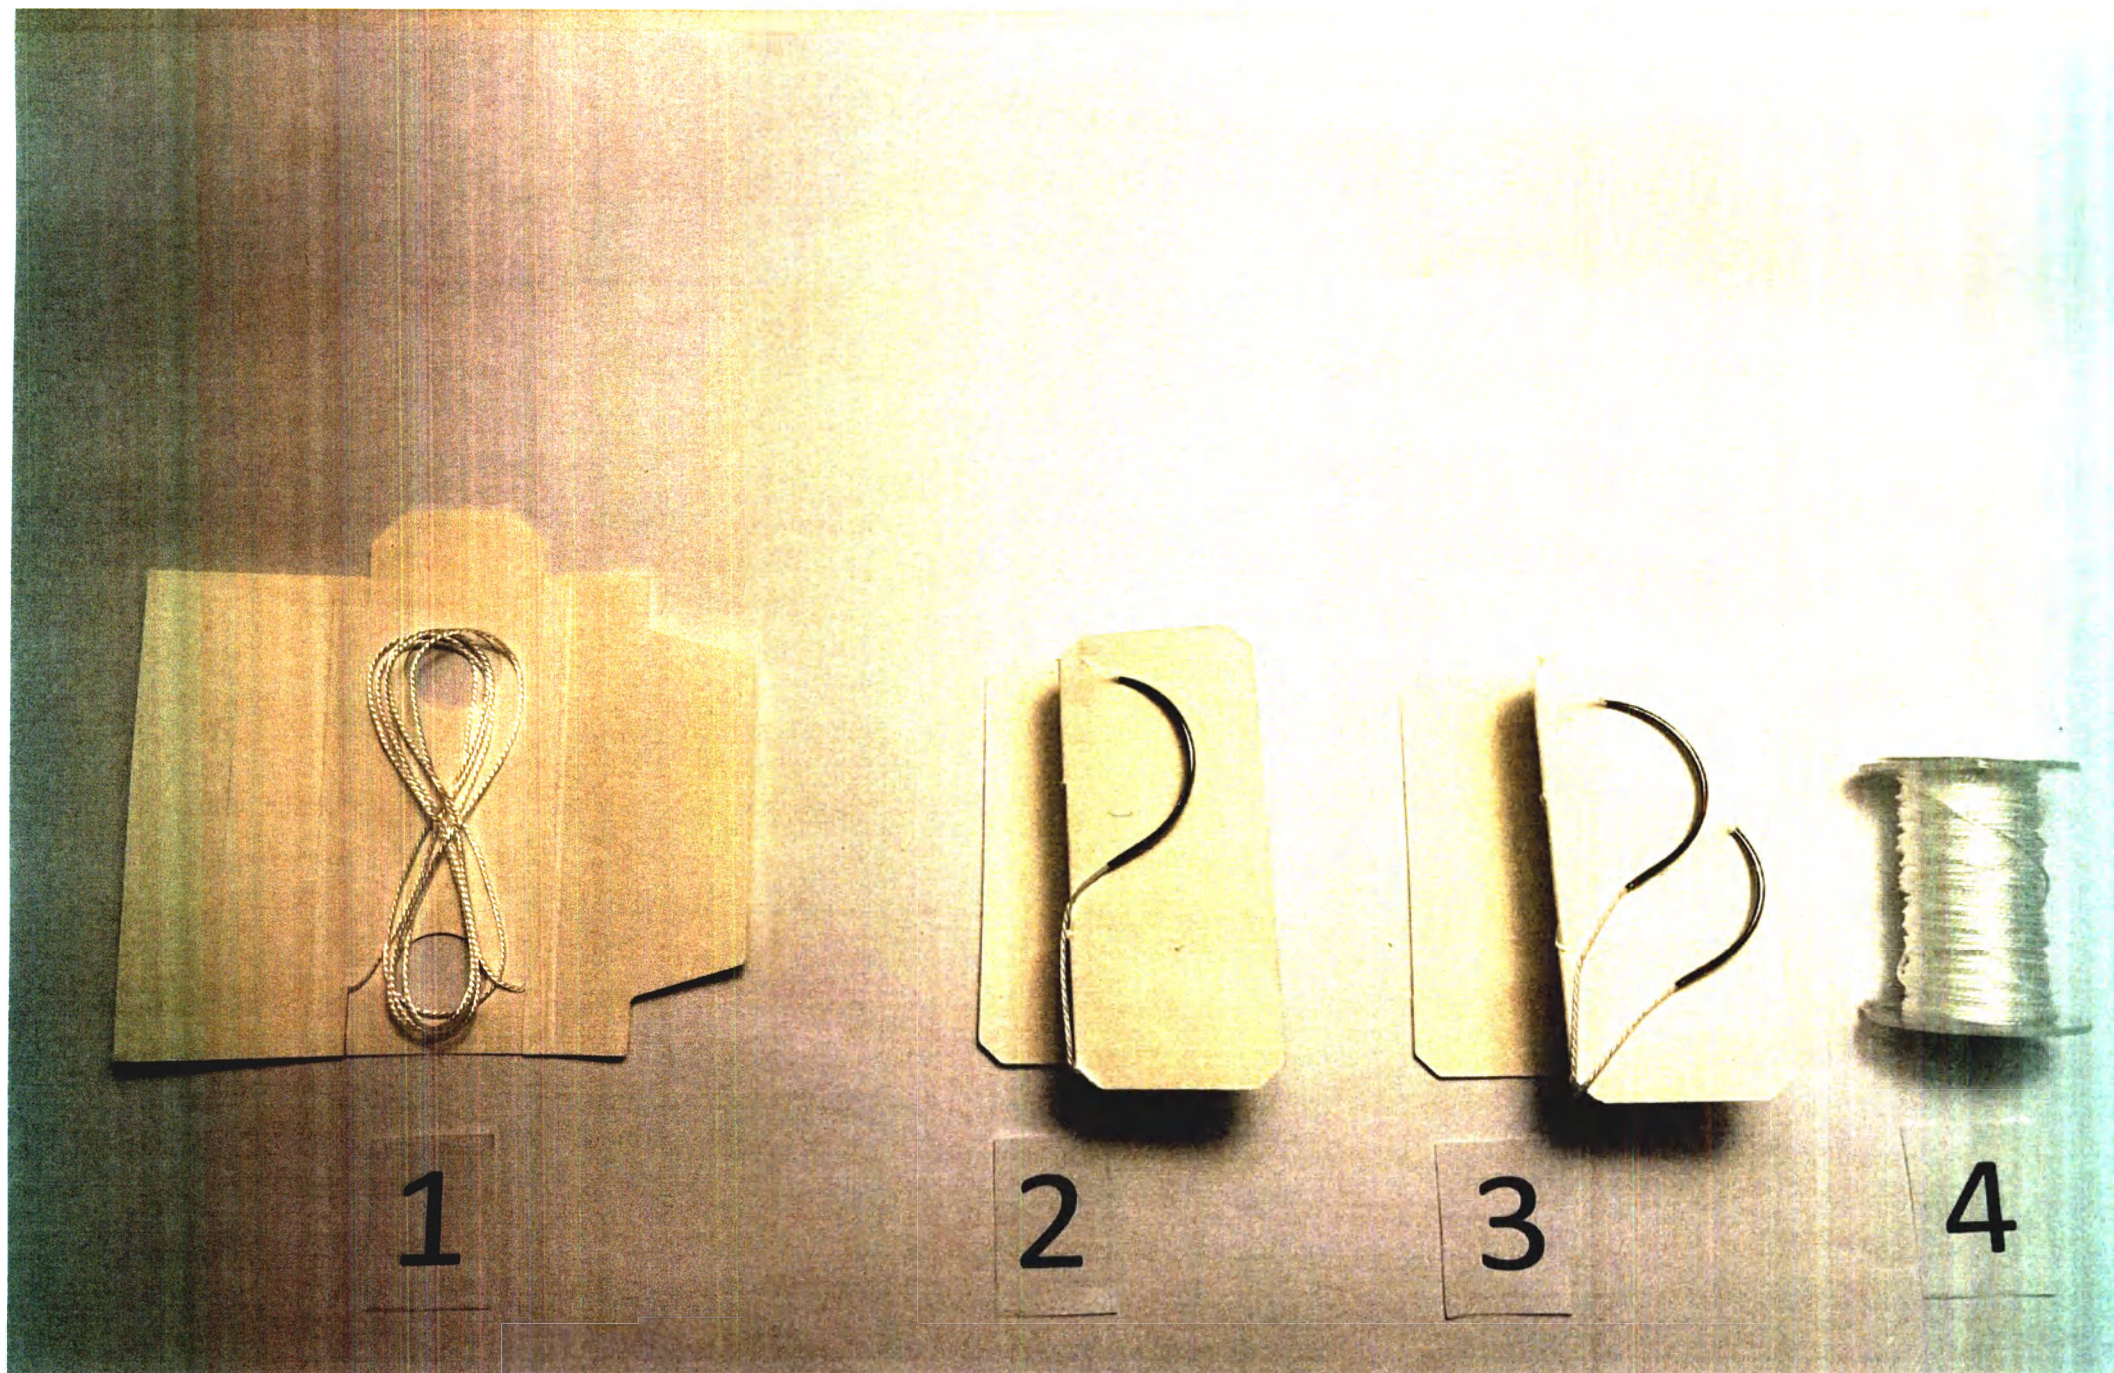


1 и 4 Нить полиамидная крученая с силиконовым покрытием неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная крученая с силиконовым покрытием неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

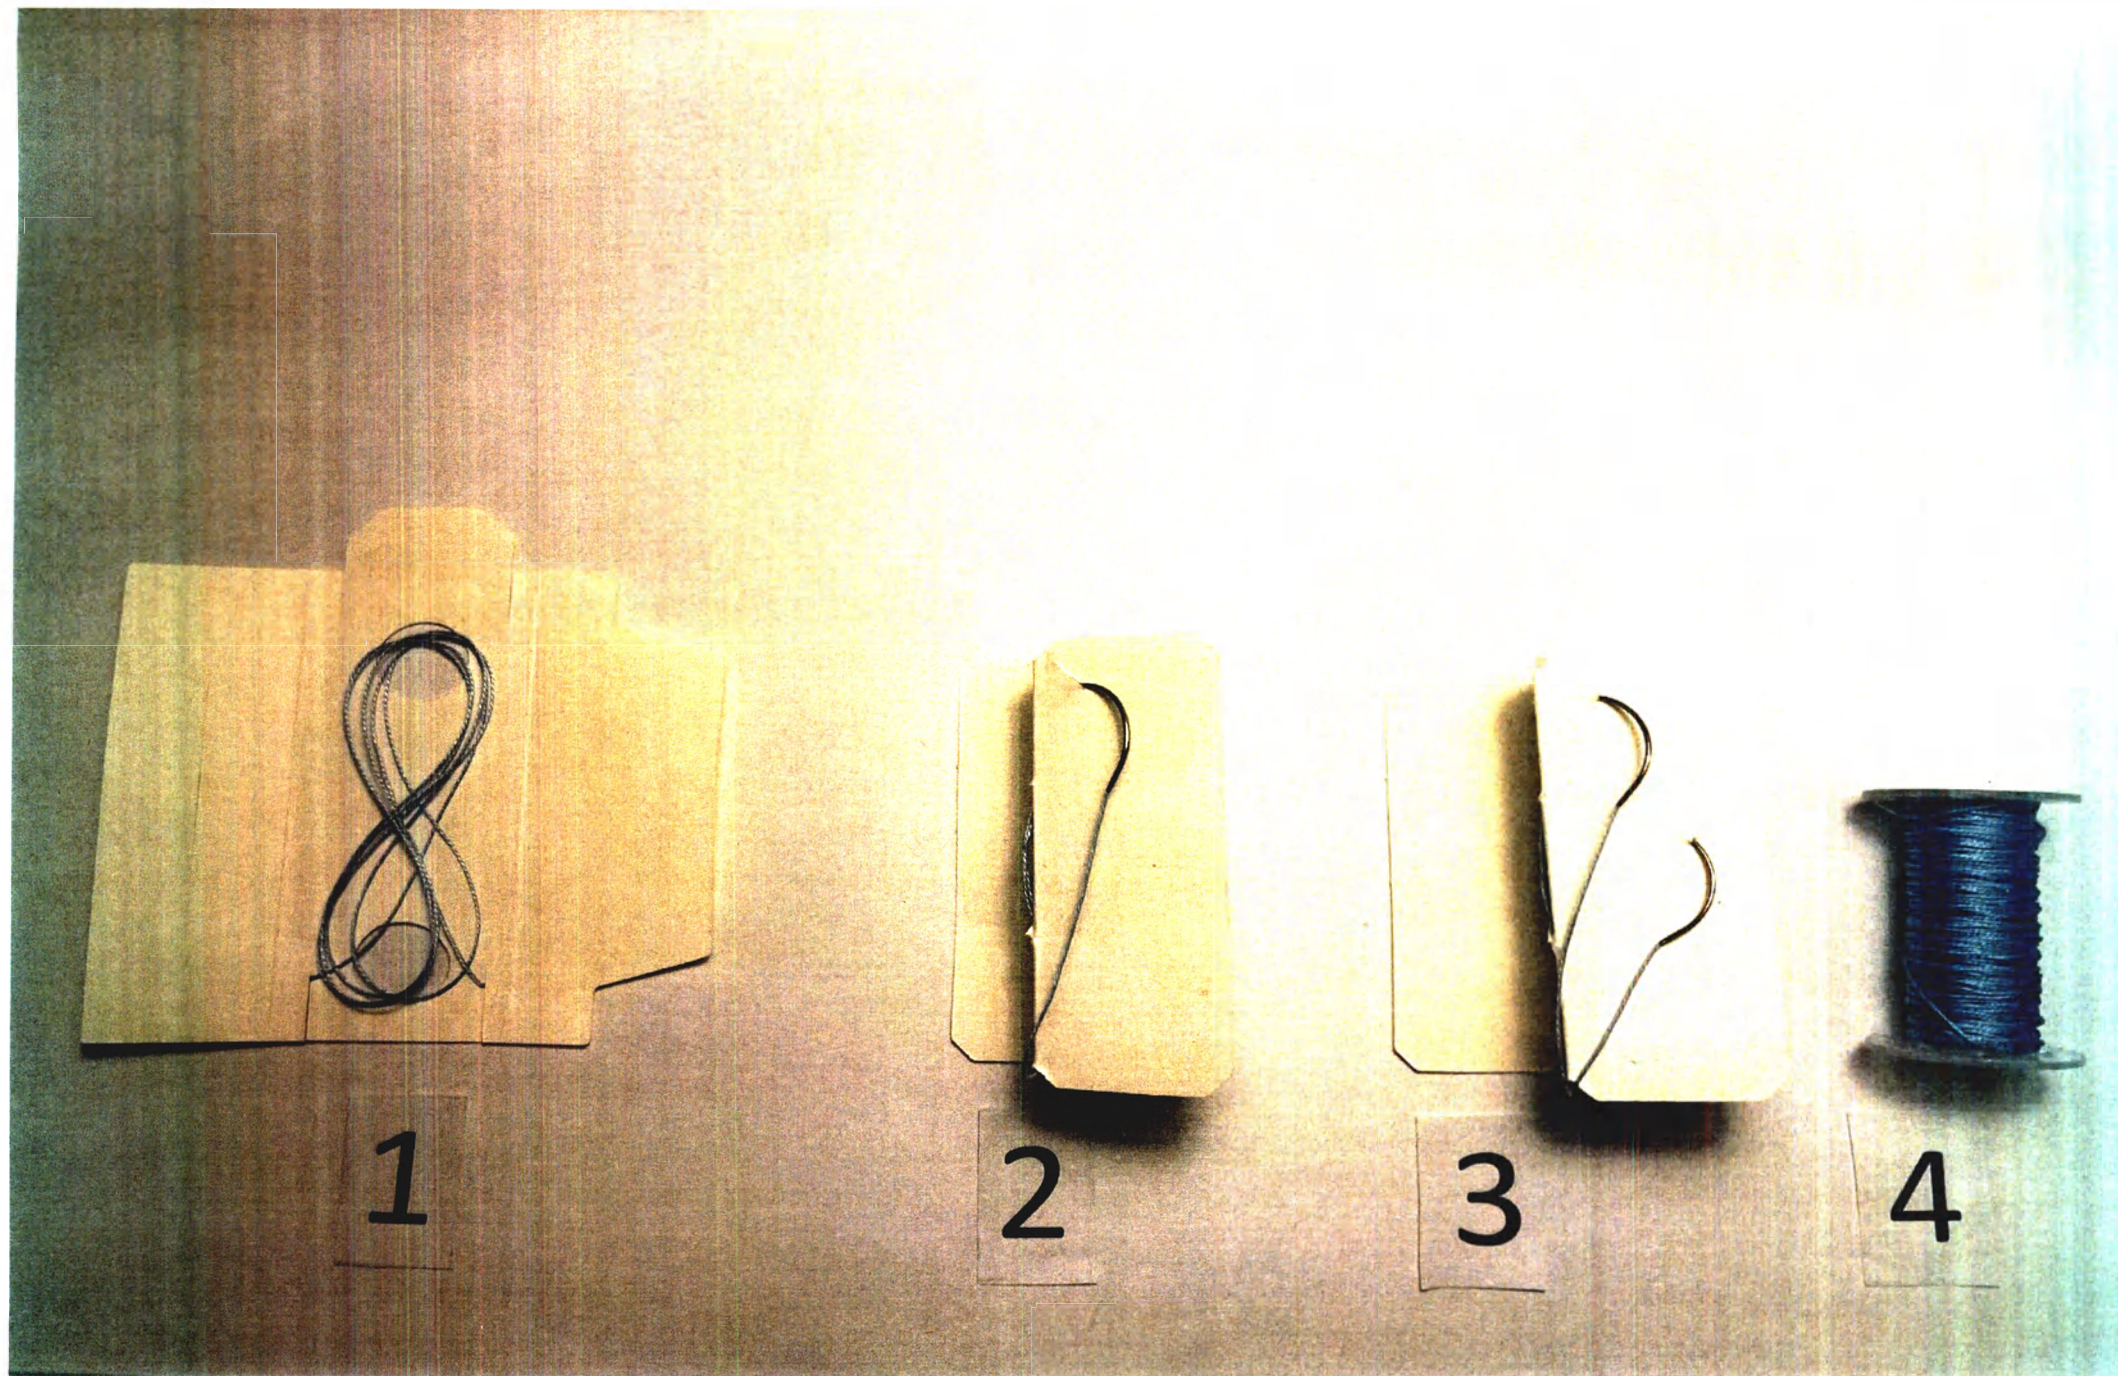


1 и 4 Нить полиамидная крученая с силиконовым покрытием окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная крученая с силиконовым покрытием окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

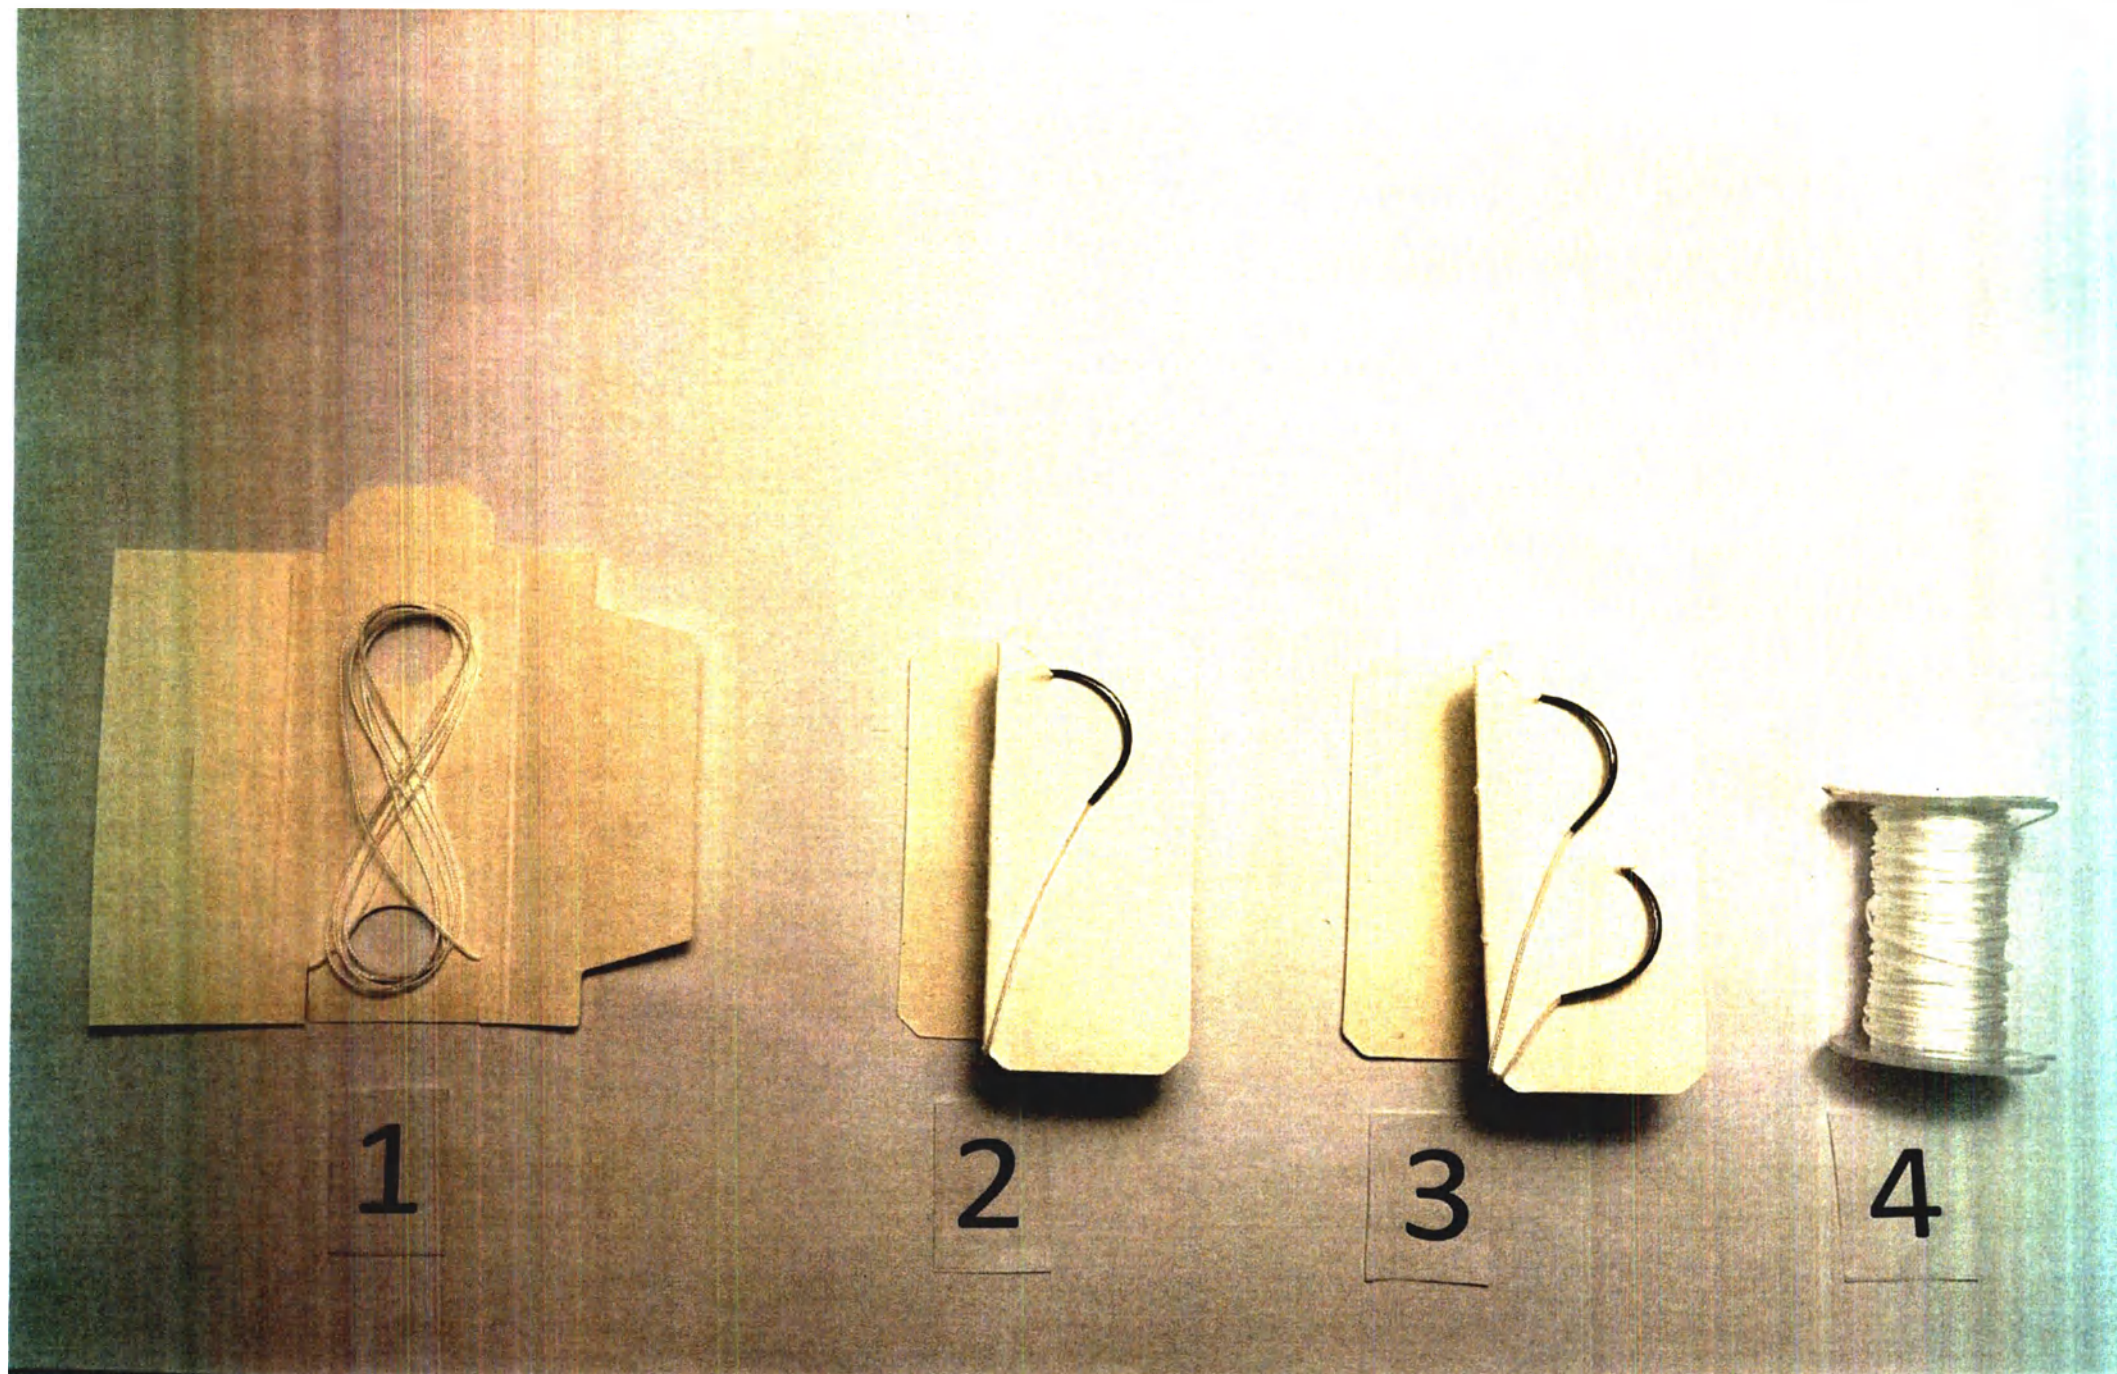


1 и 4 Нить полиамидная плетеная неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная плетеная неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

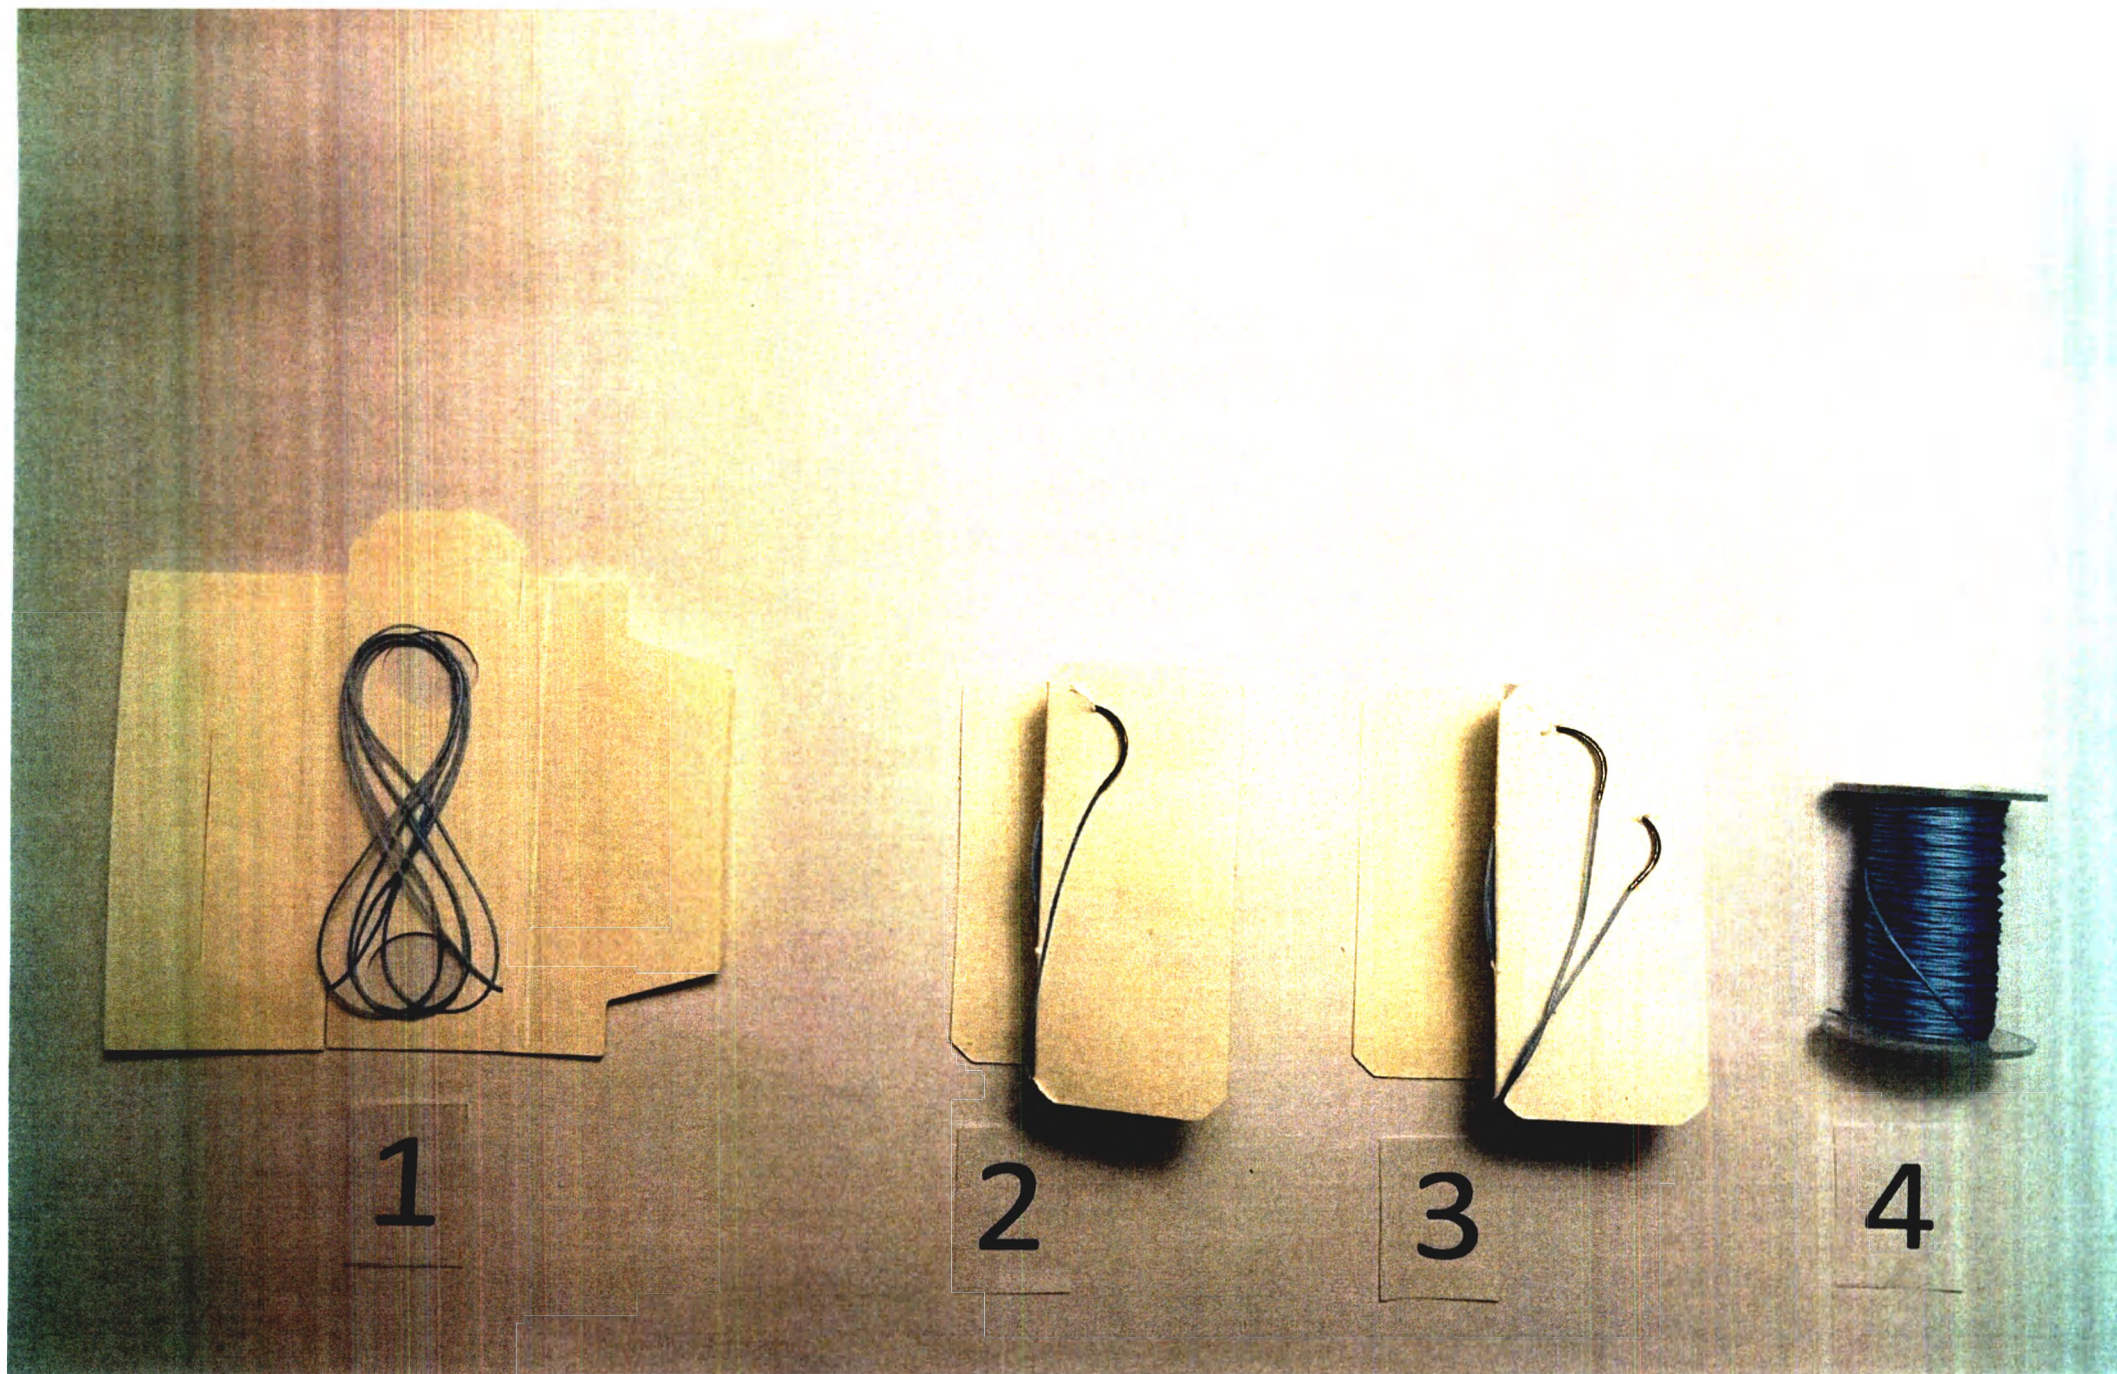


1 и 4 Нить полиамидная плетеная окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная плетеная окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

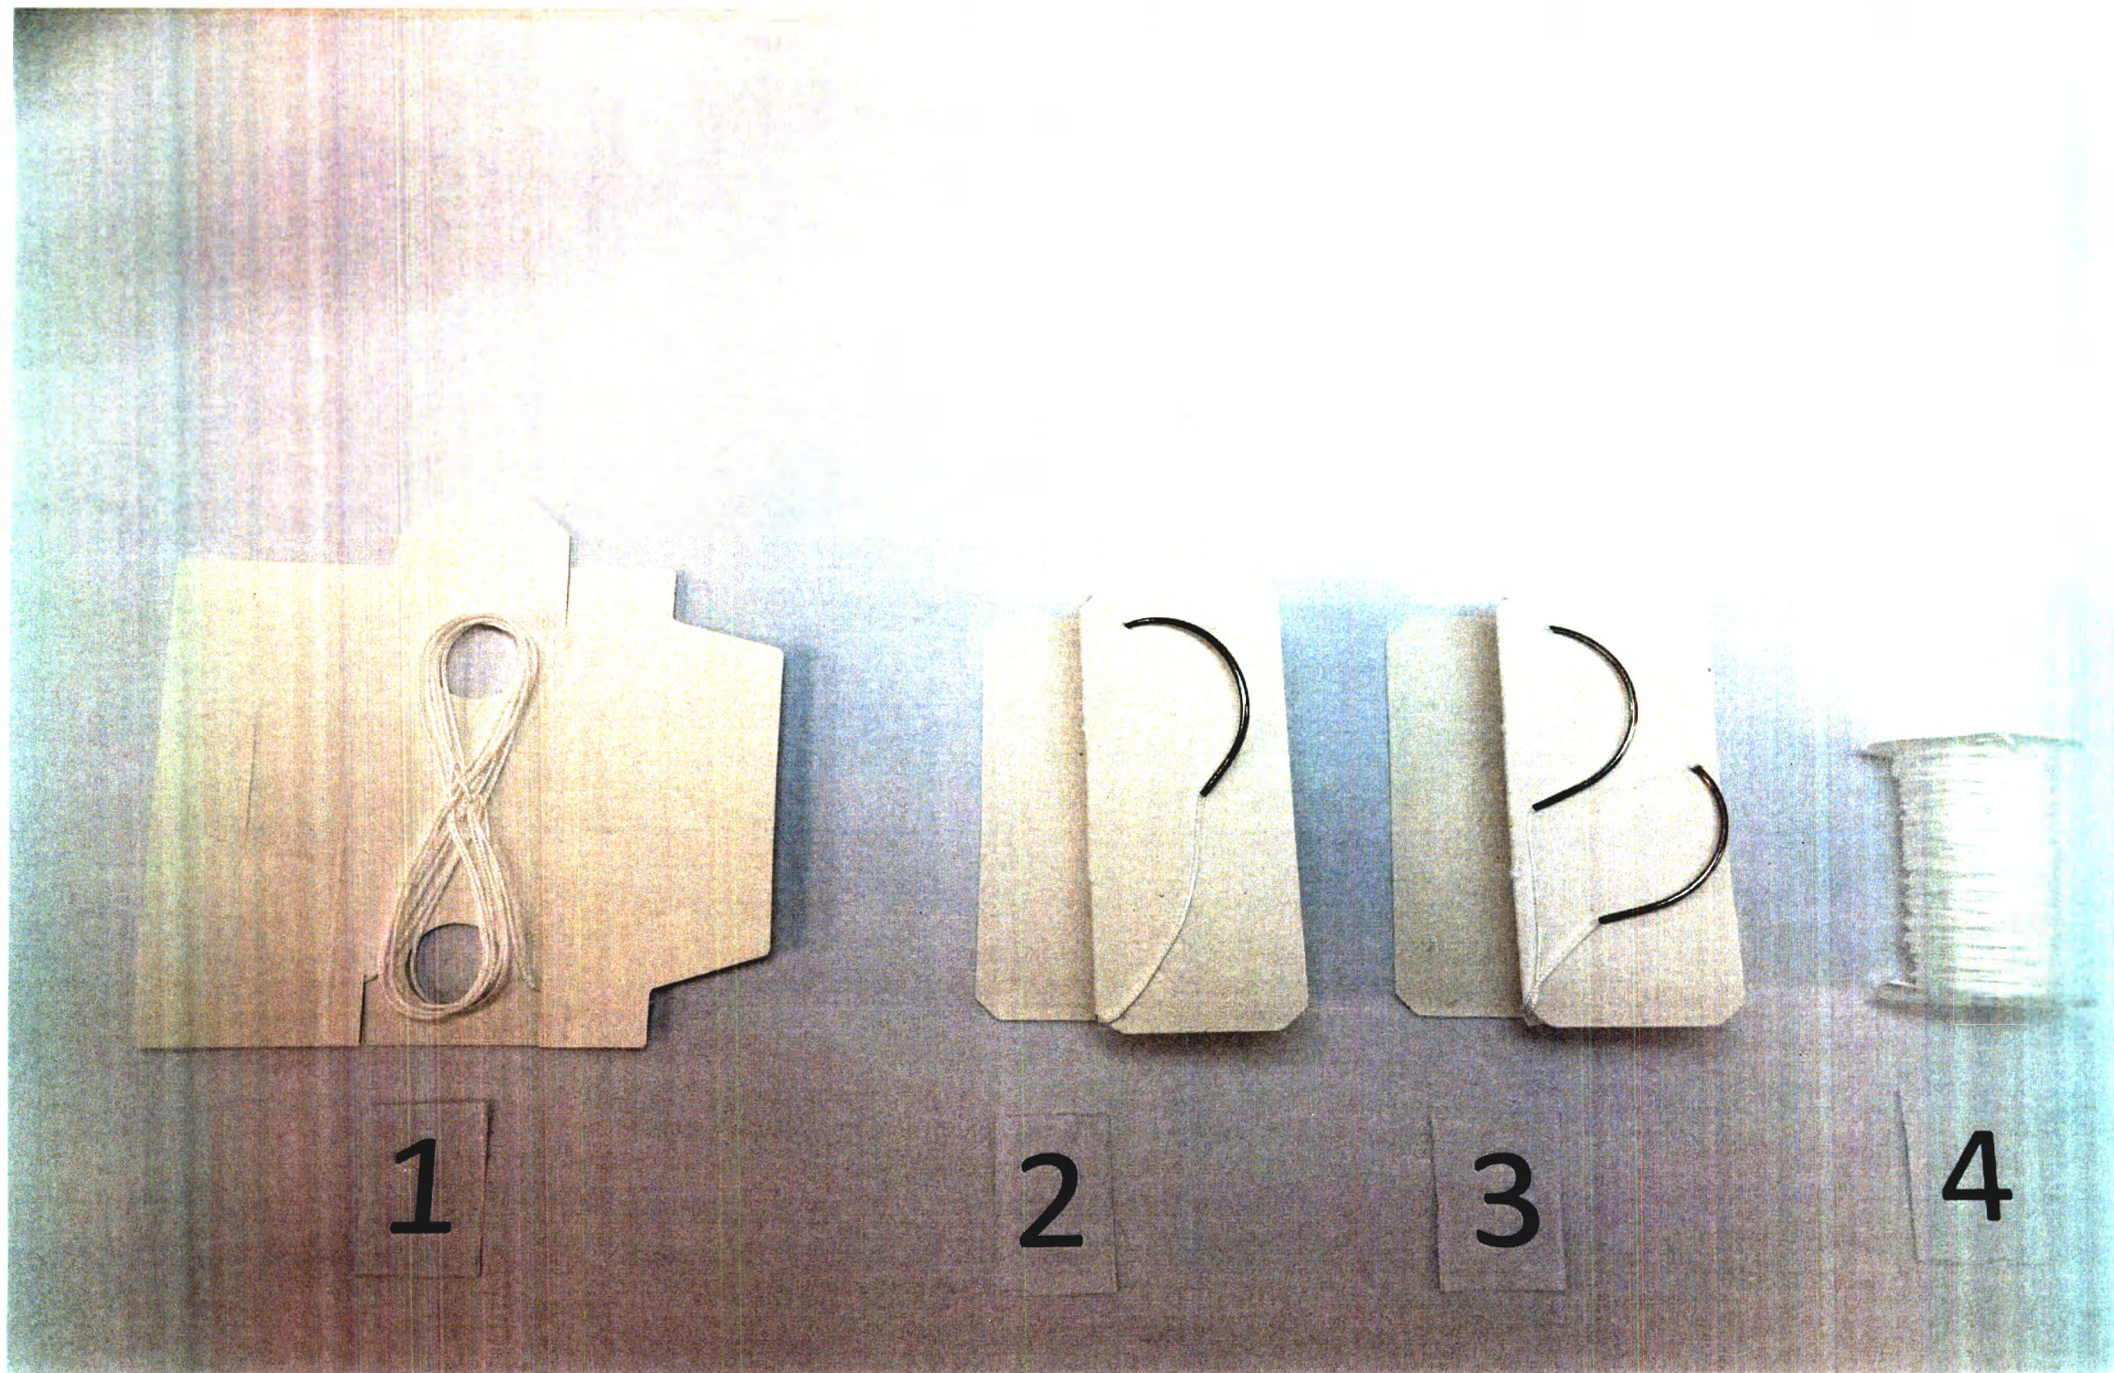


1 и 4 Нить полиамидная плетеная с фторполимерным покрытием неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная плетеная с фторполимерным покрытием неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

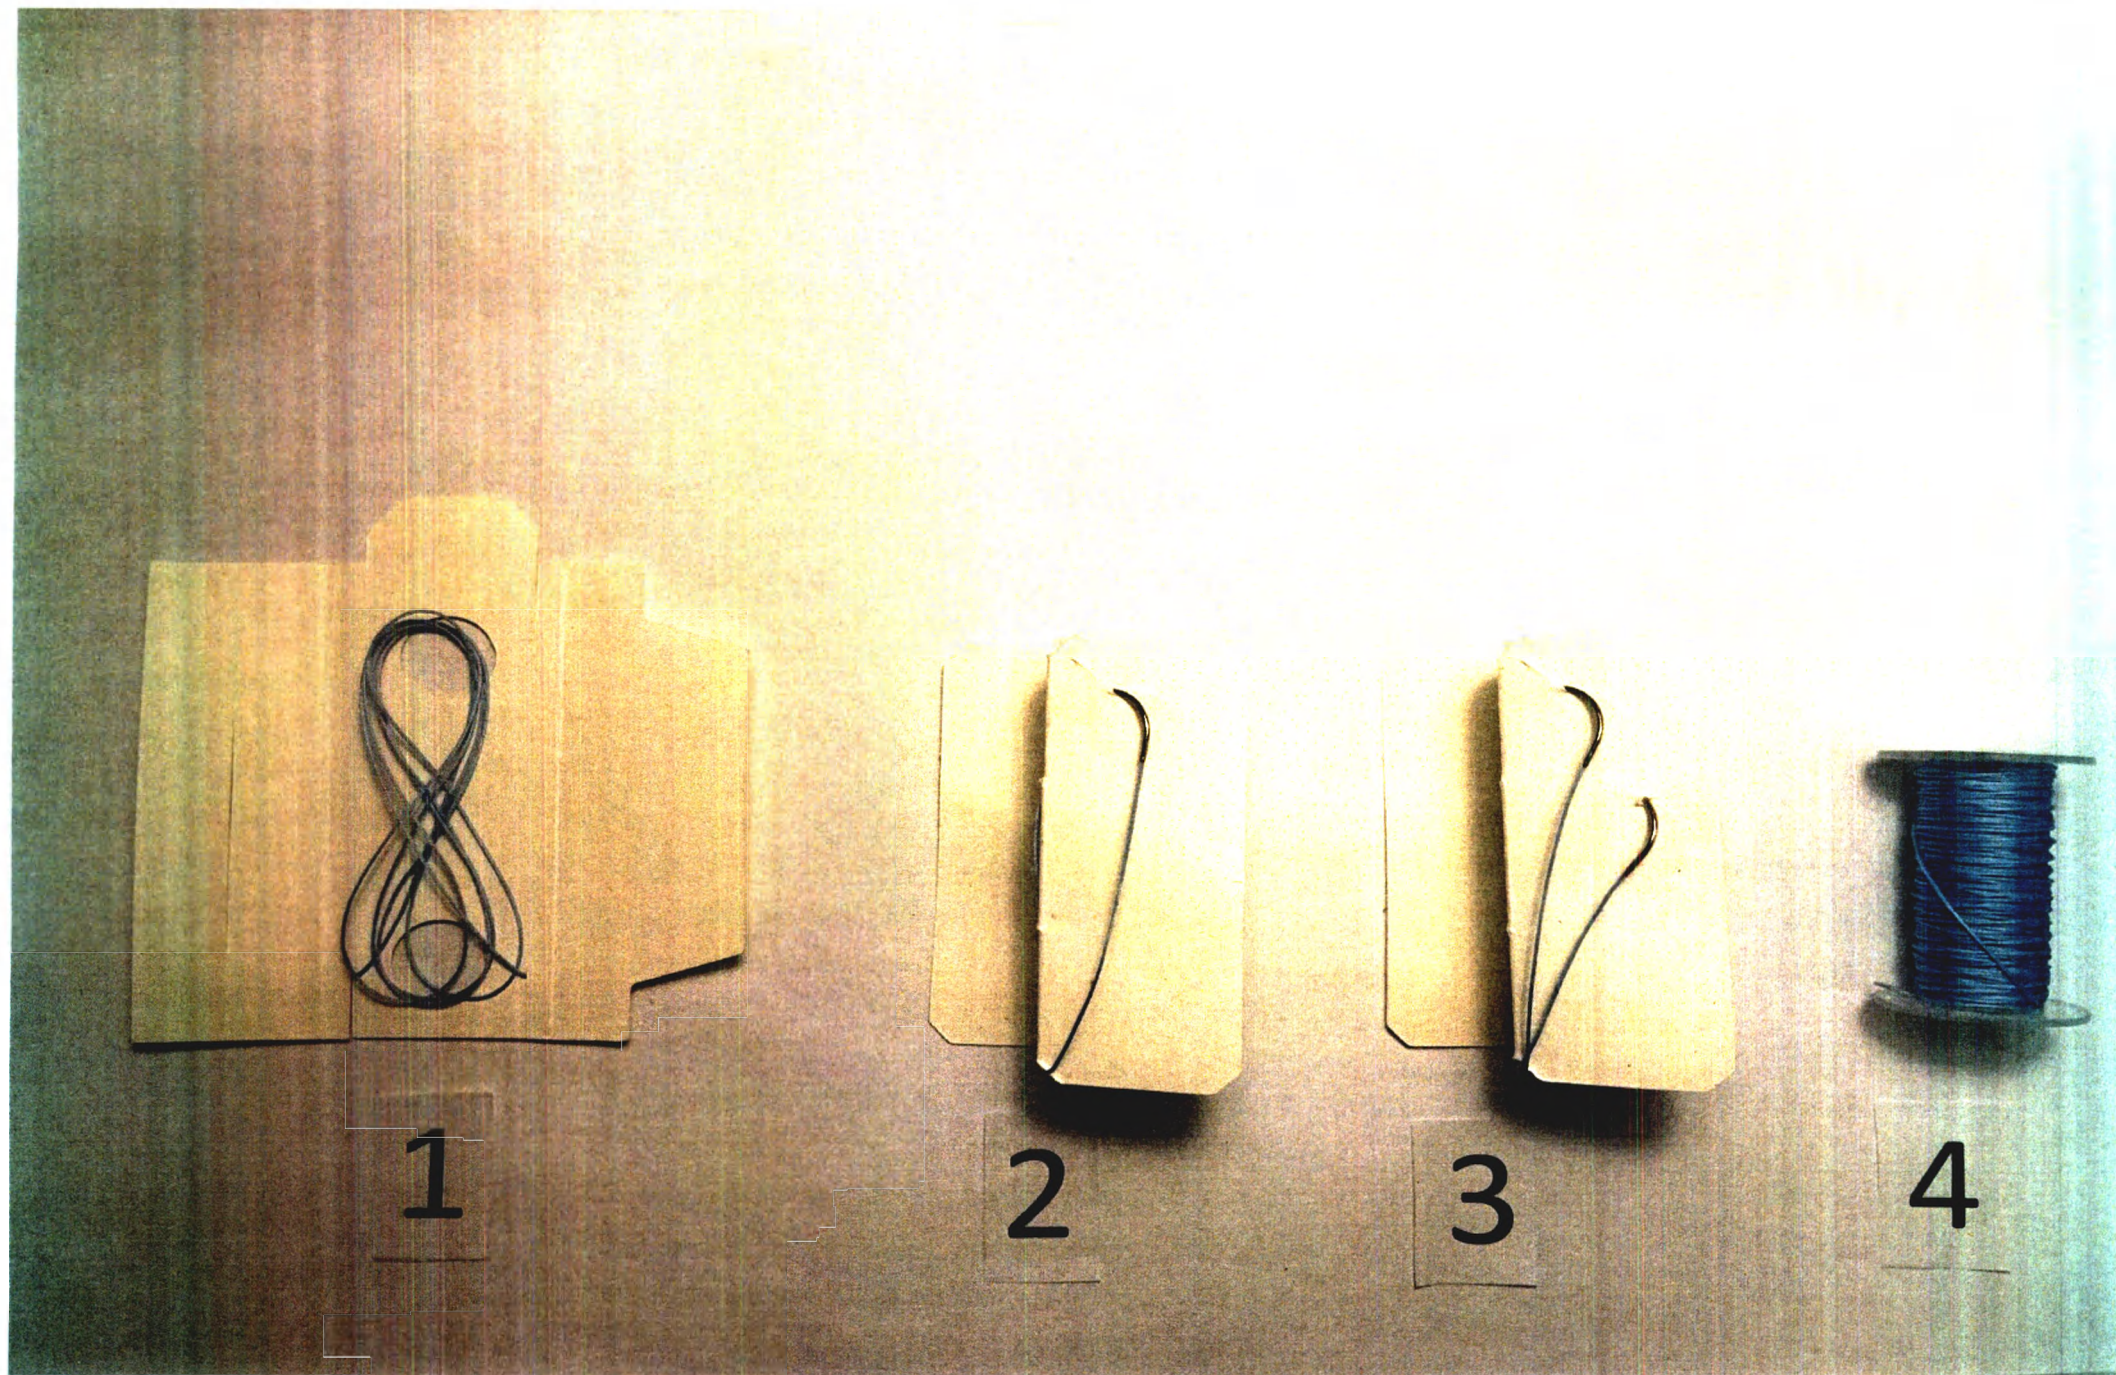


1 и 4 Нить полиамидная плетеная с фторполимерным покрытием окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная плетеная с фторполимерным покрытием окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

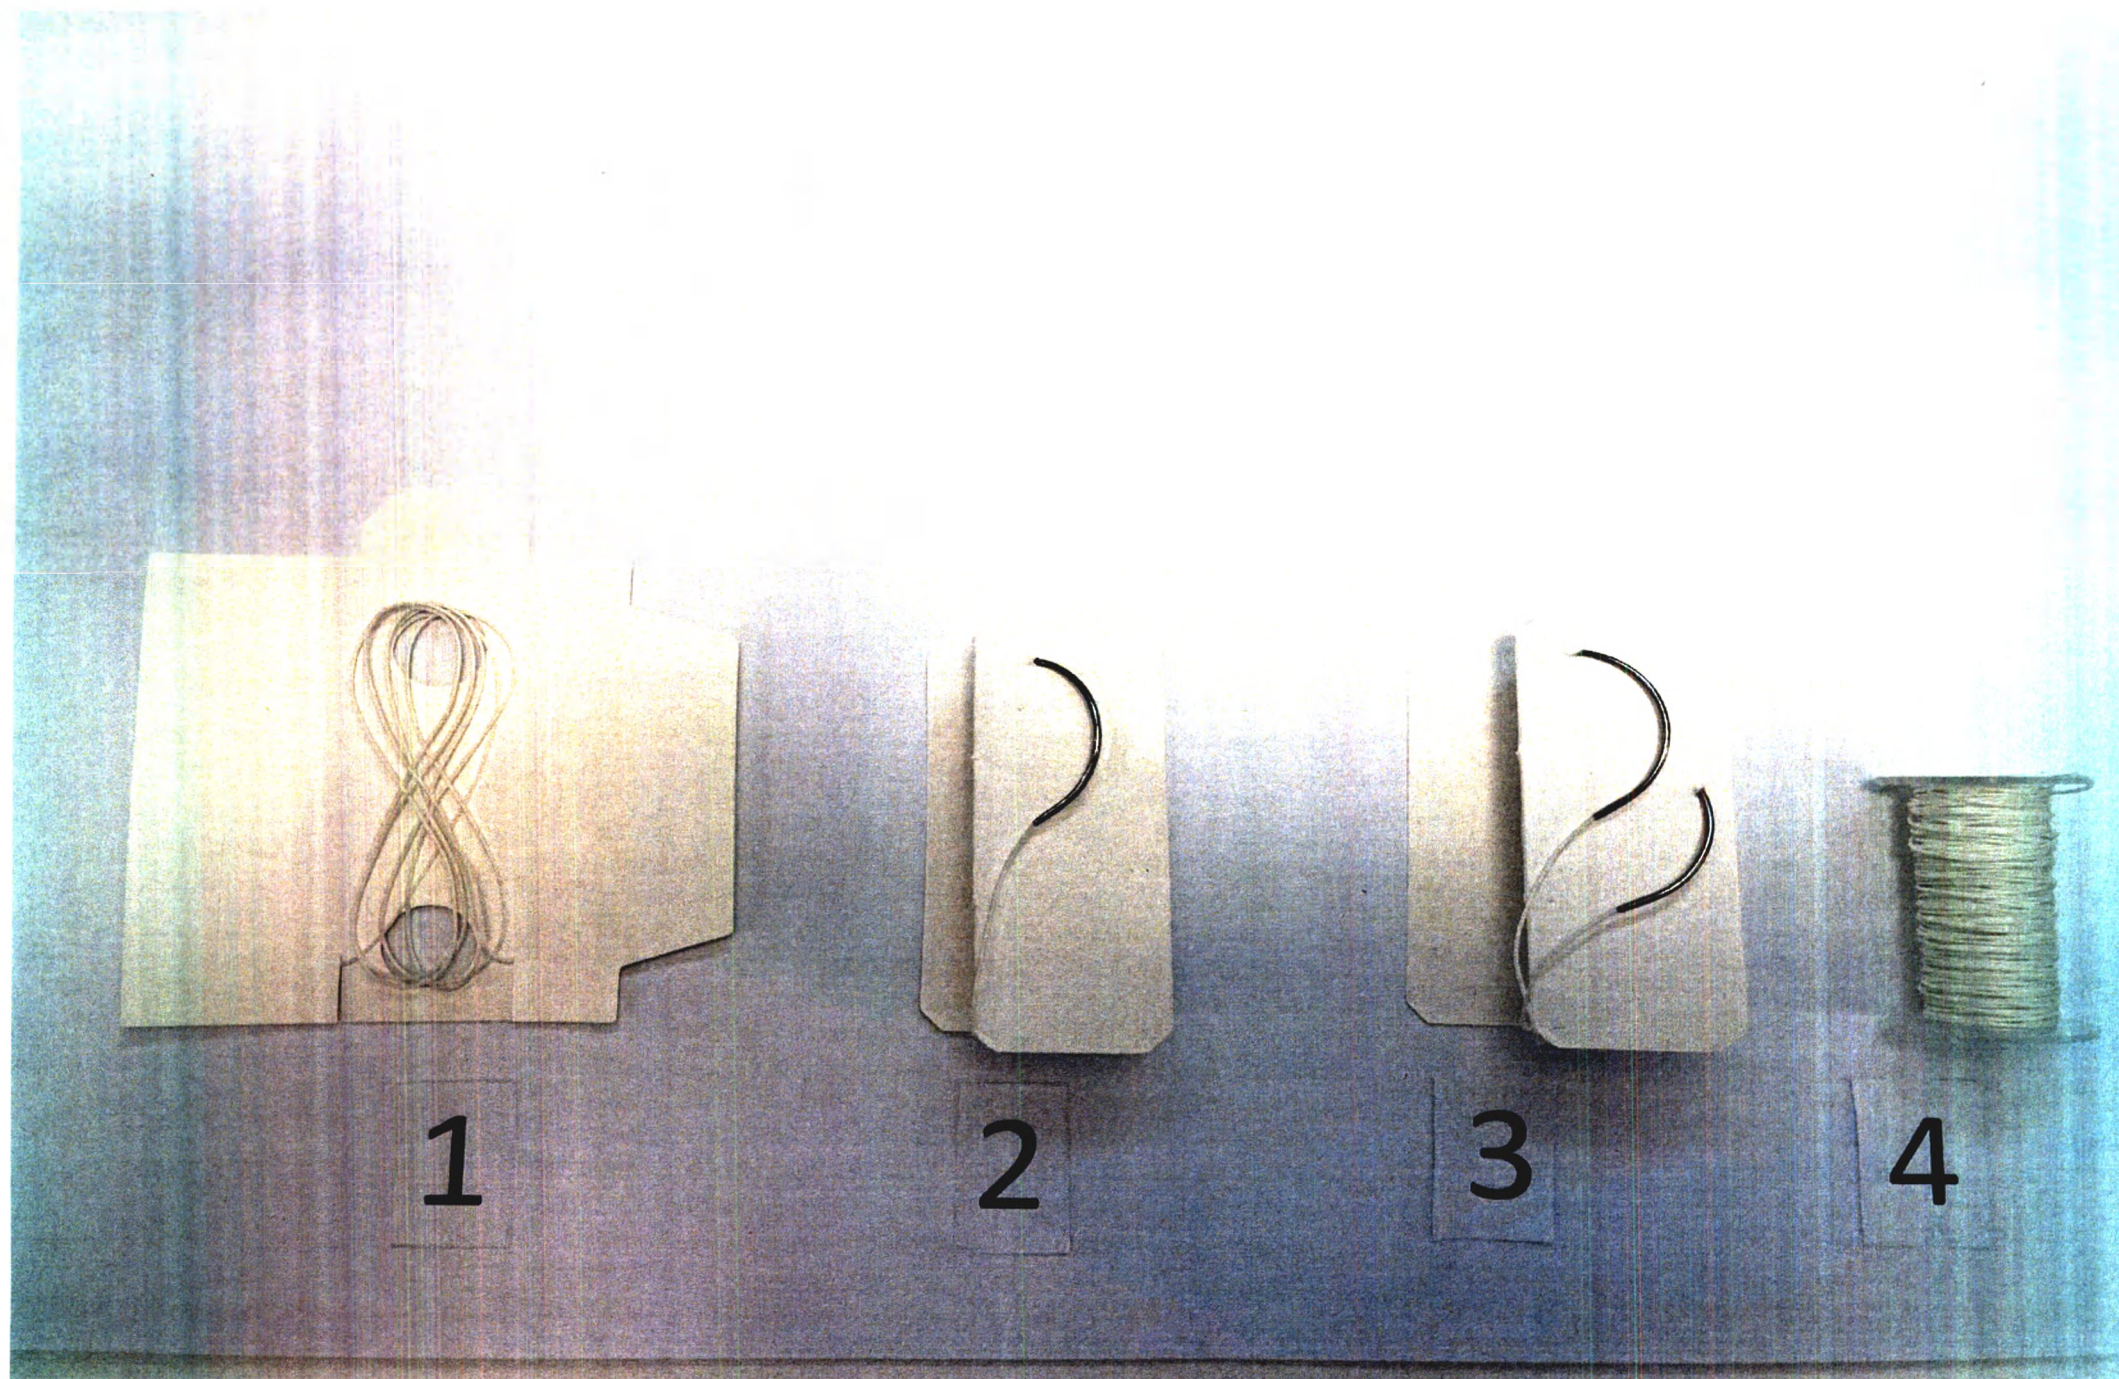


1 и 4 Нить полиамидная плетеная с силиконовым покрытием неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная плетеная с силиконовым покрытием неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

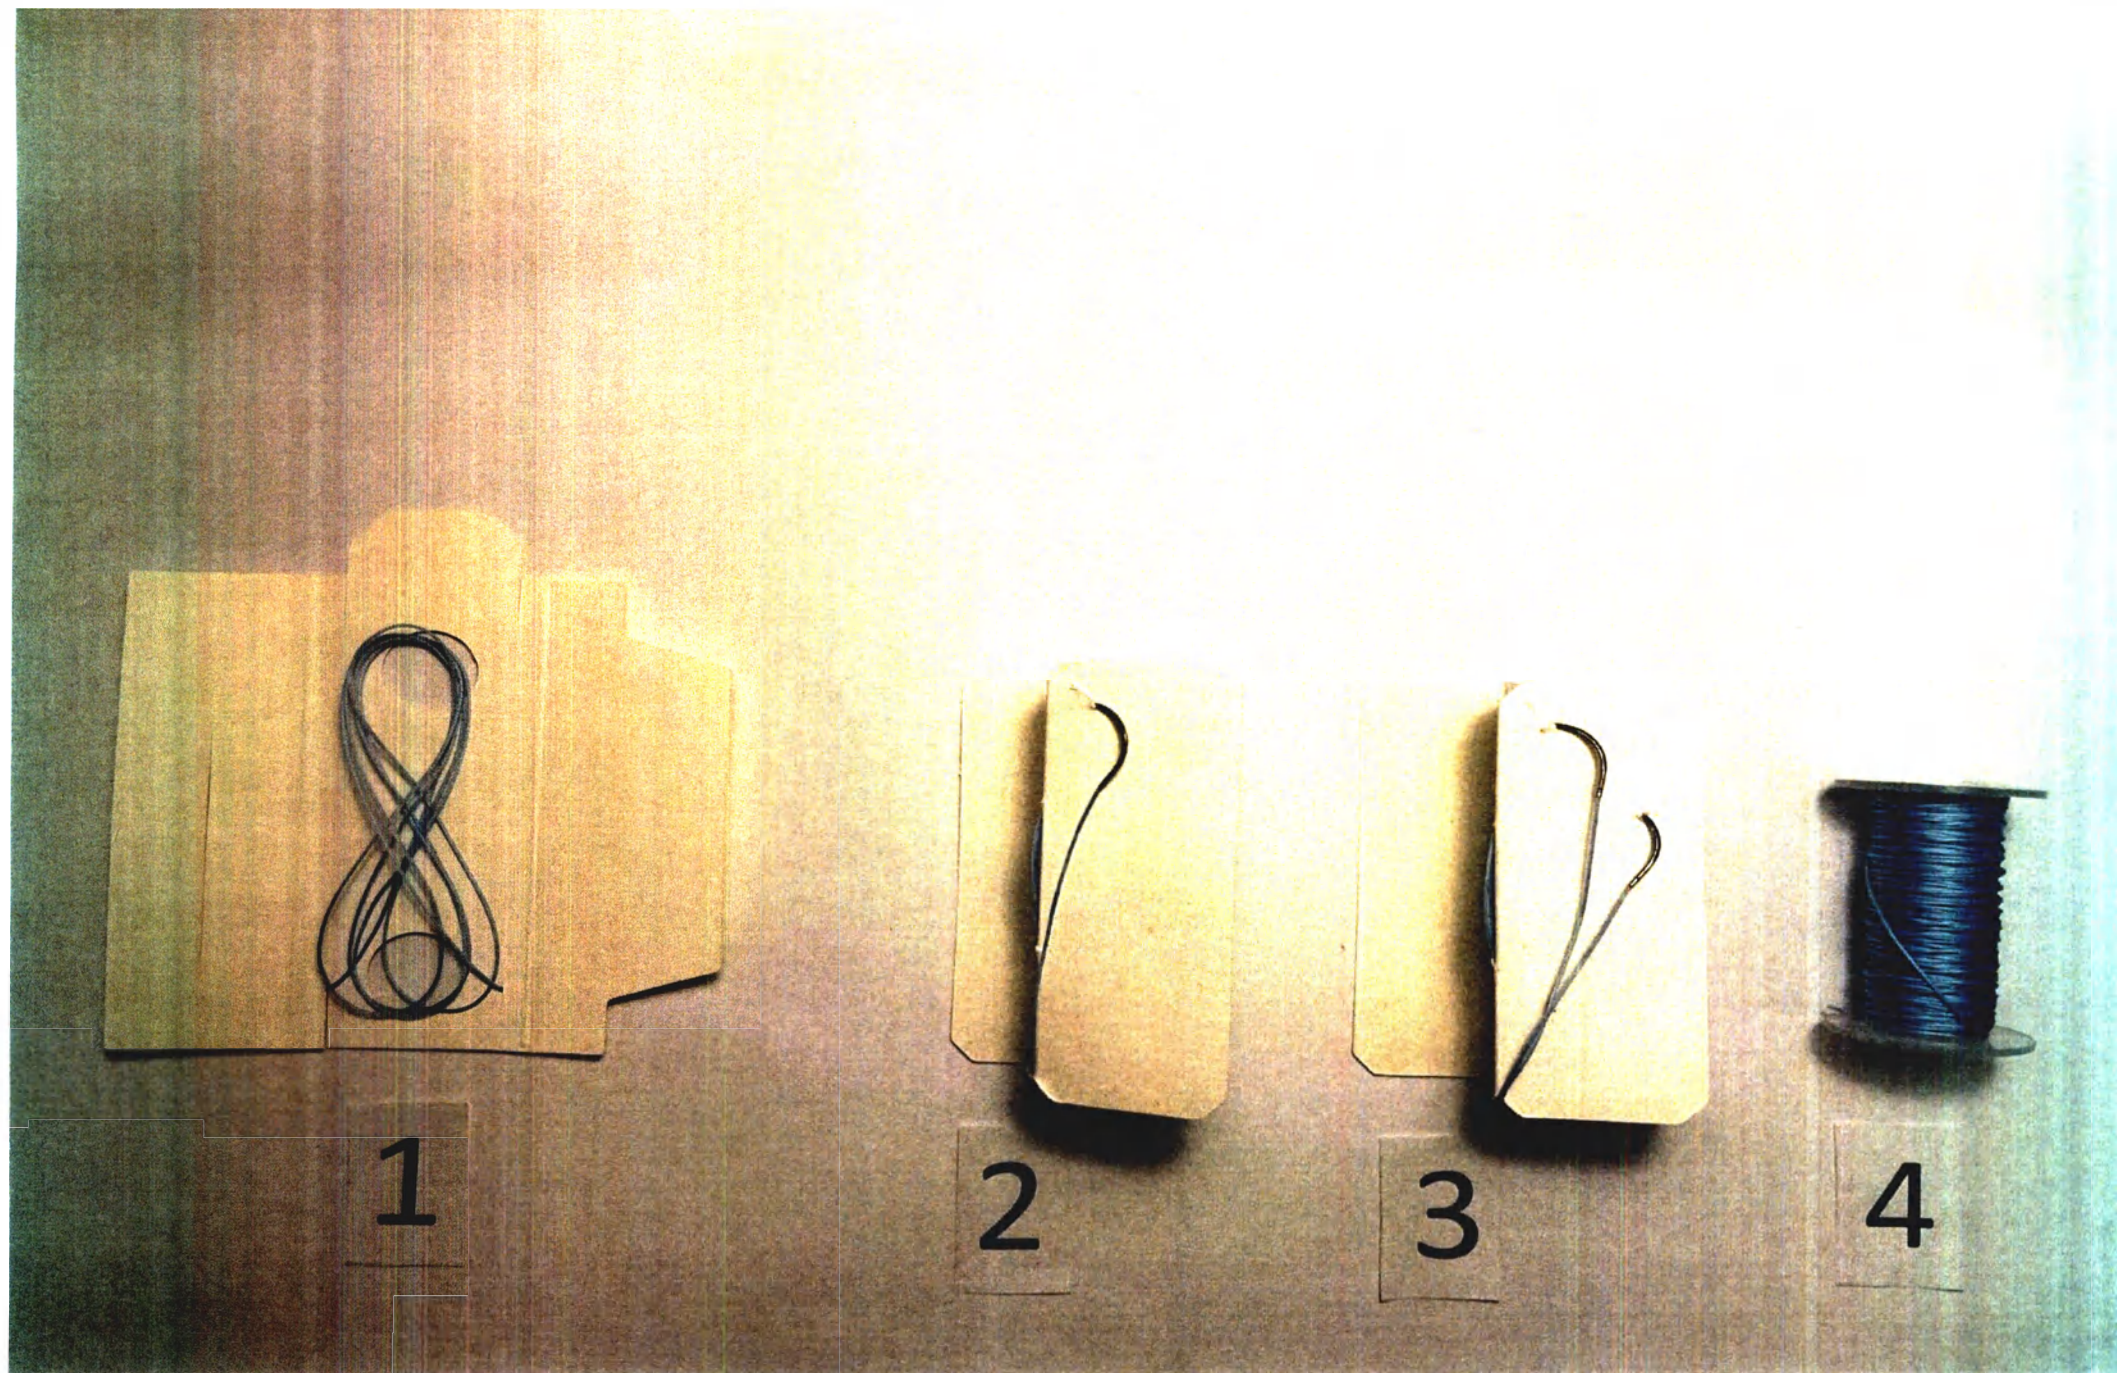


1 и 4 Нить полиамидная плетеная с силиконовым покрытием окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить полиамидная плетеная с силиконовым покрытием окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

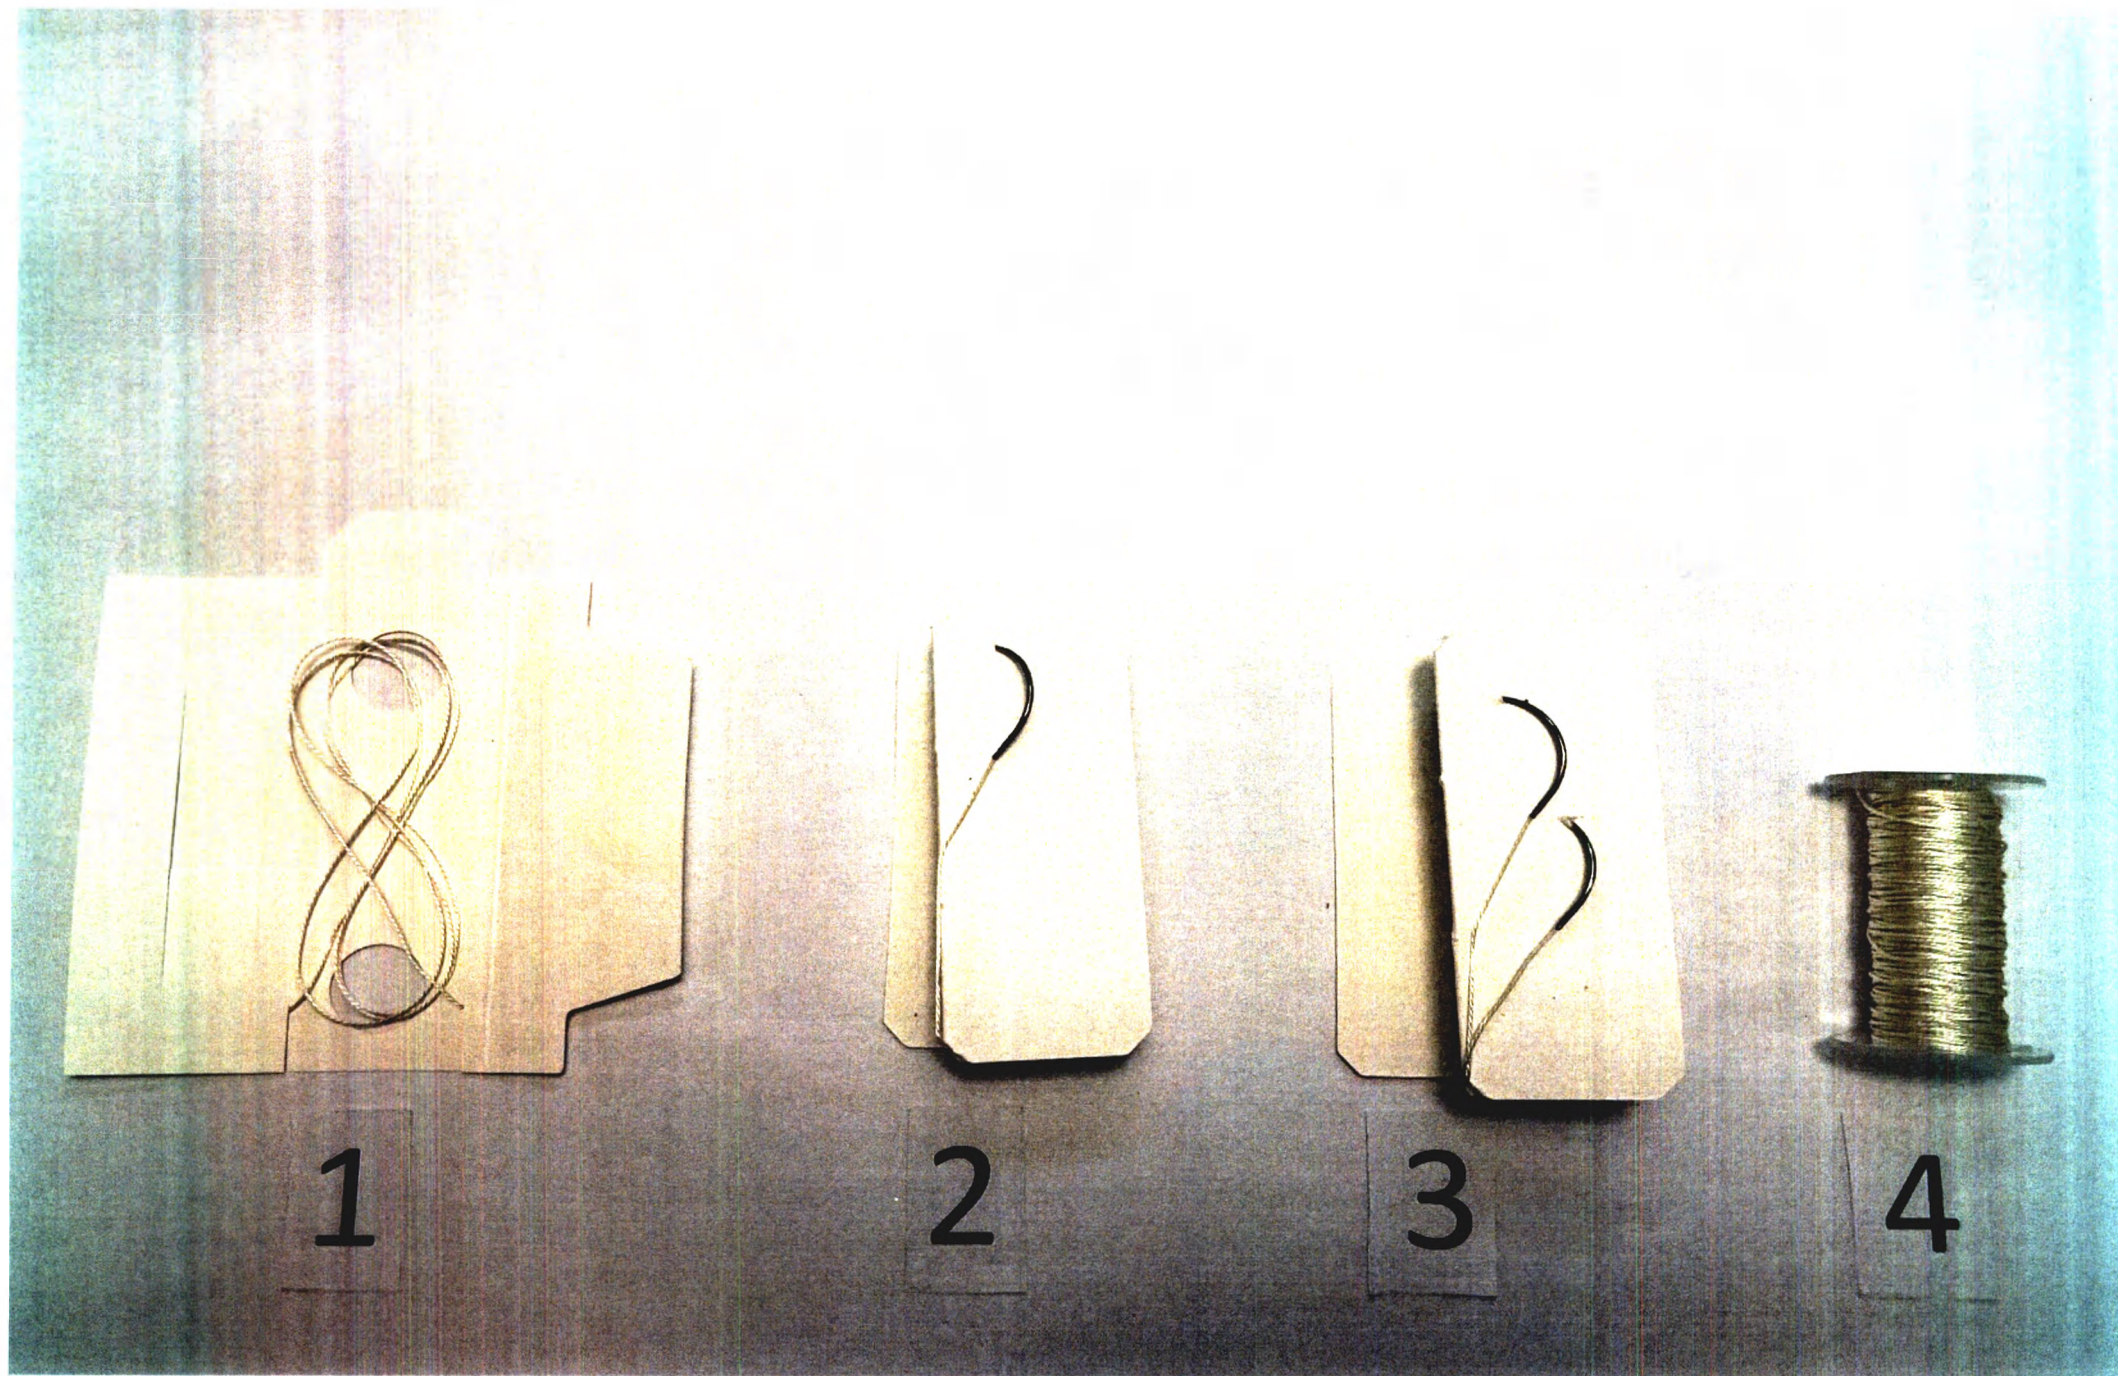


1 и 4 Нить шелковая крученая неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить шелковая крученая неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

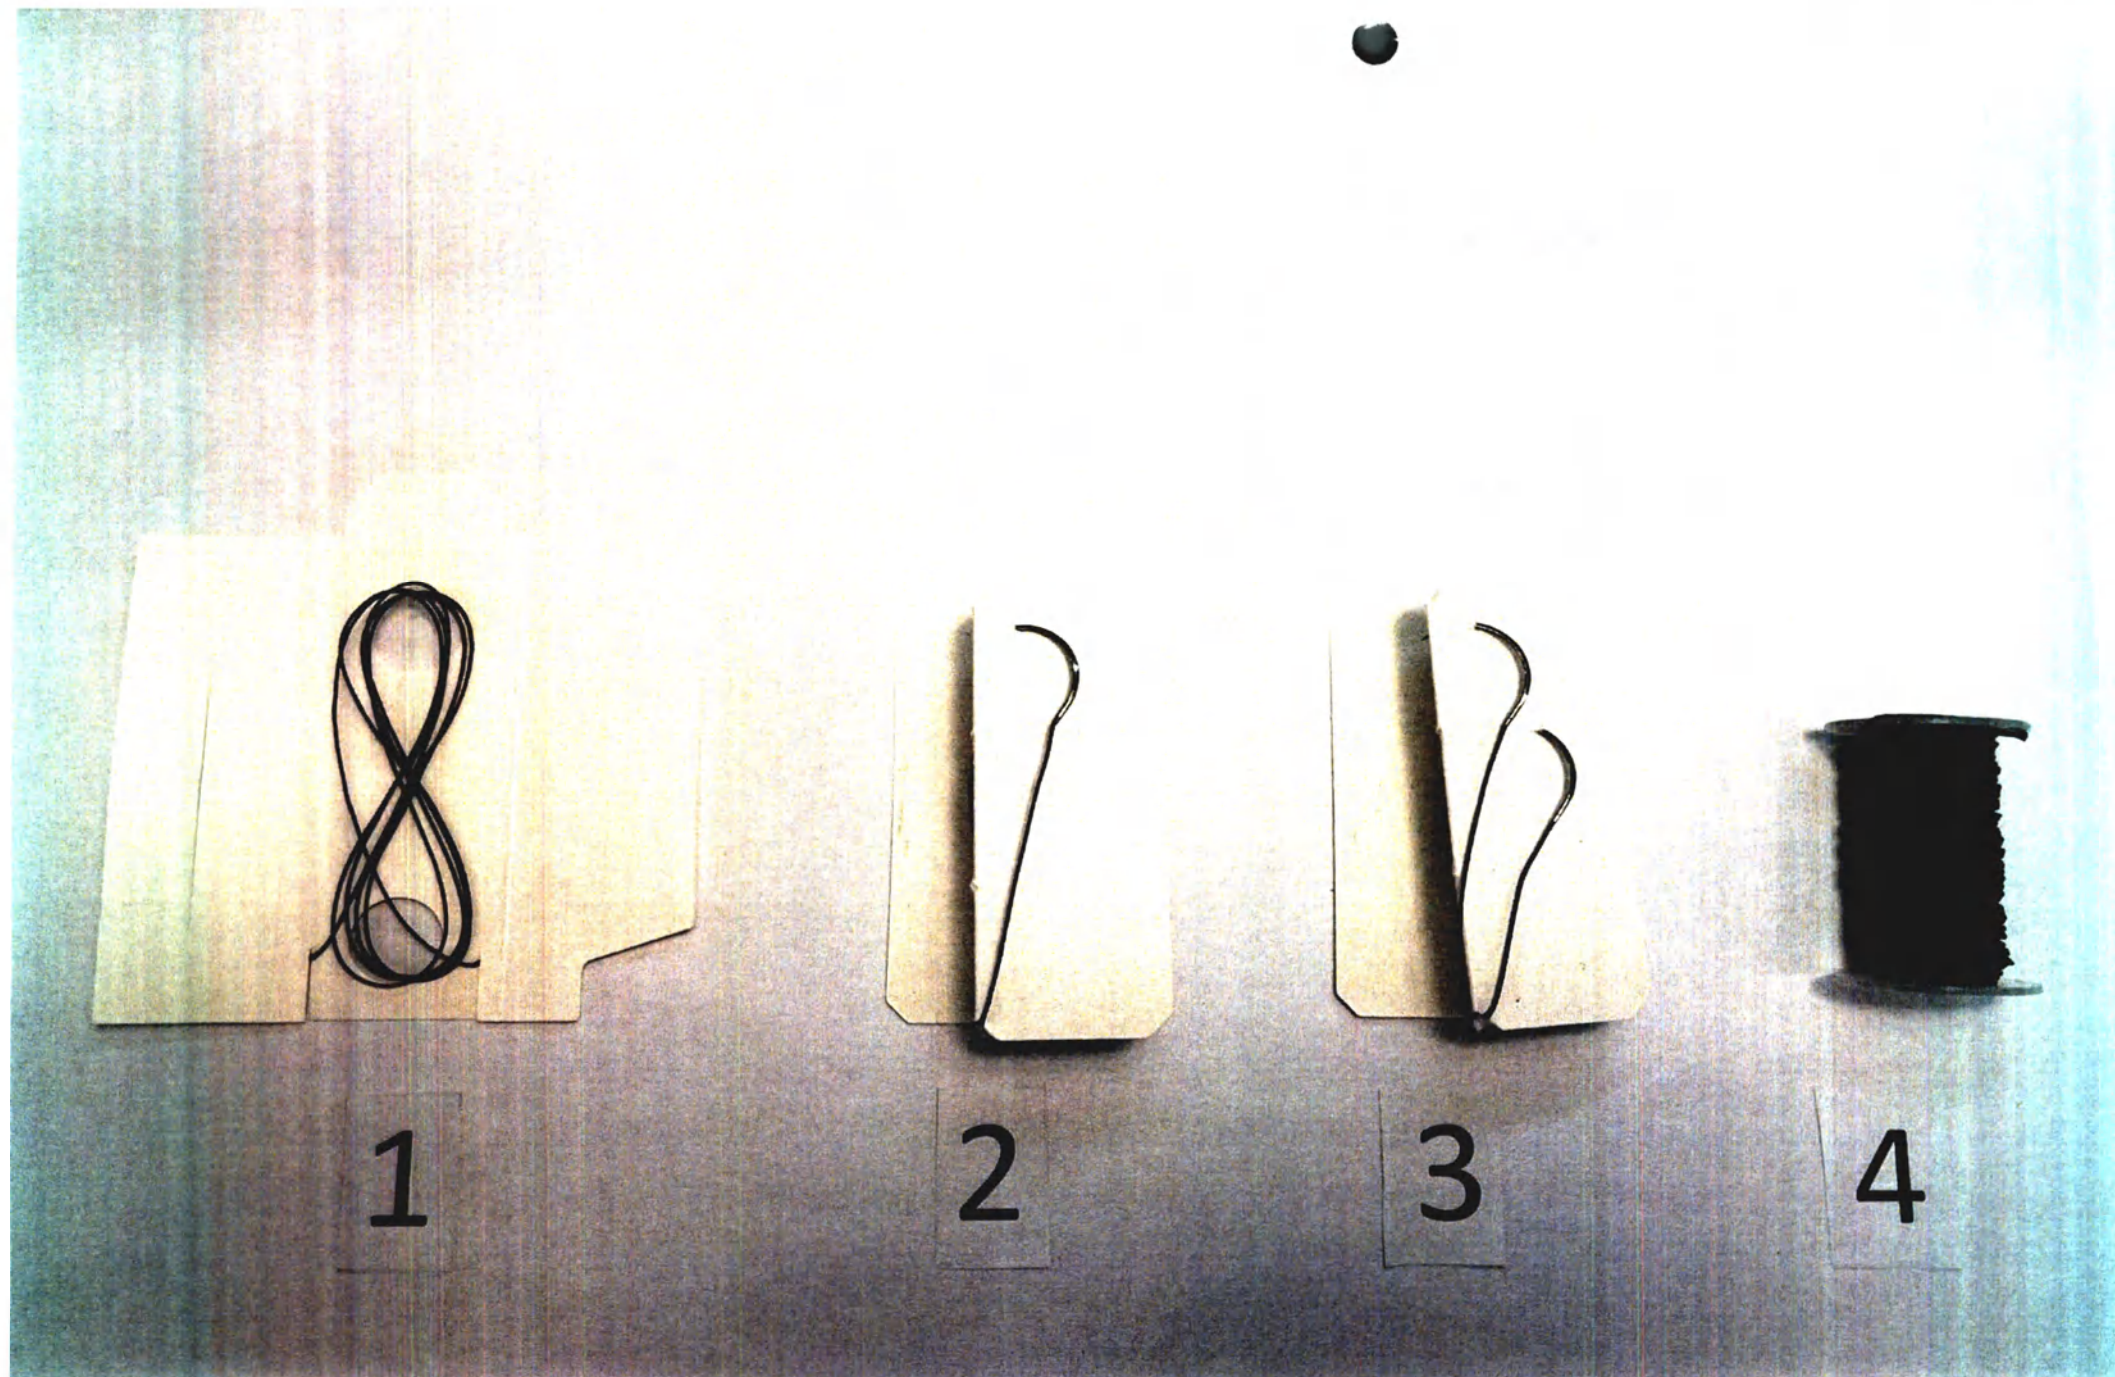


1 и 4 Нить шелковая крученая окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить шелковая крученая окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

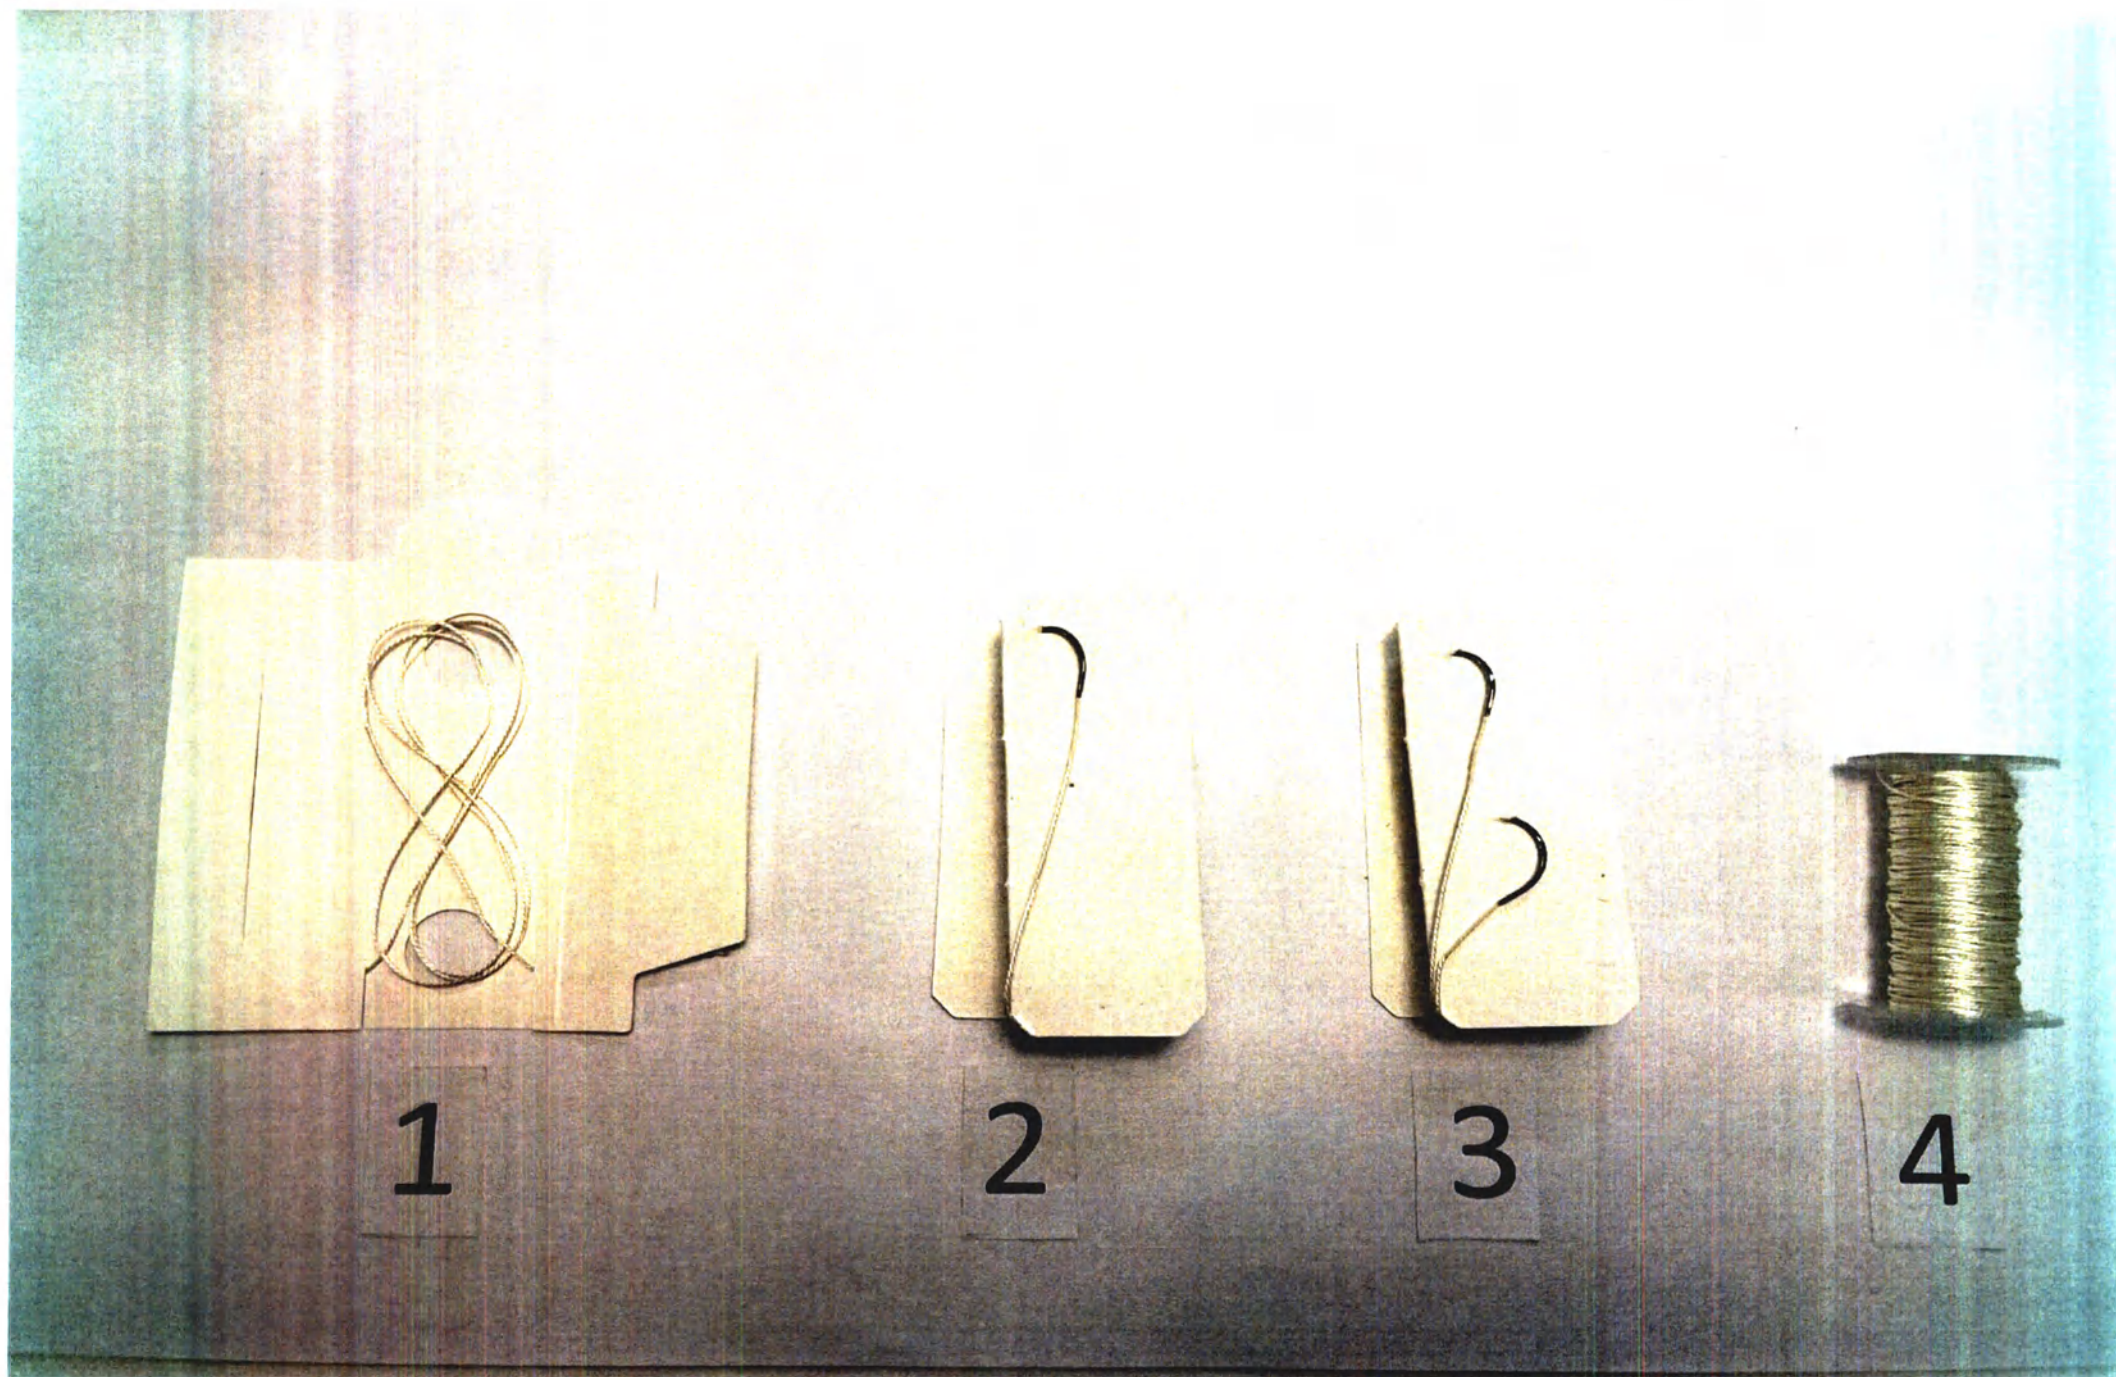


1 и 4 Нить шелковая крученая с силиконовым покрытием неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить шелковая крученая с силиконовым покрытием неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

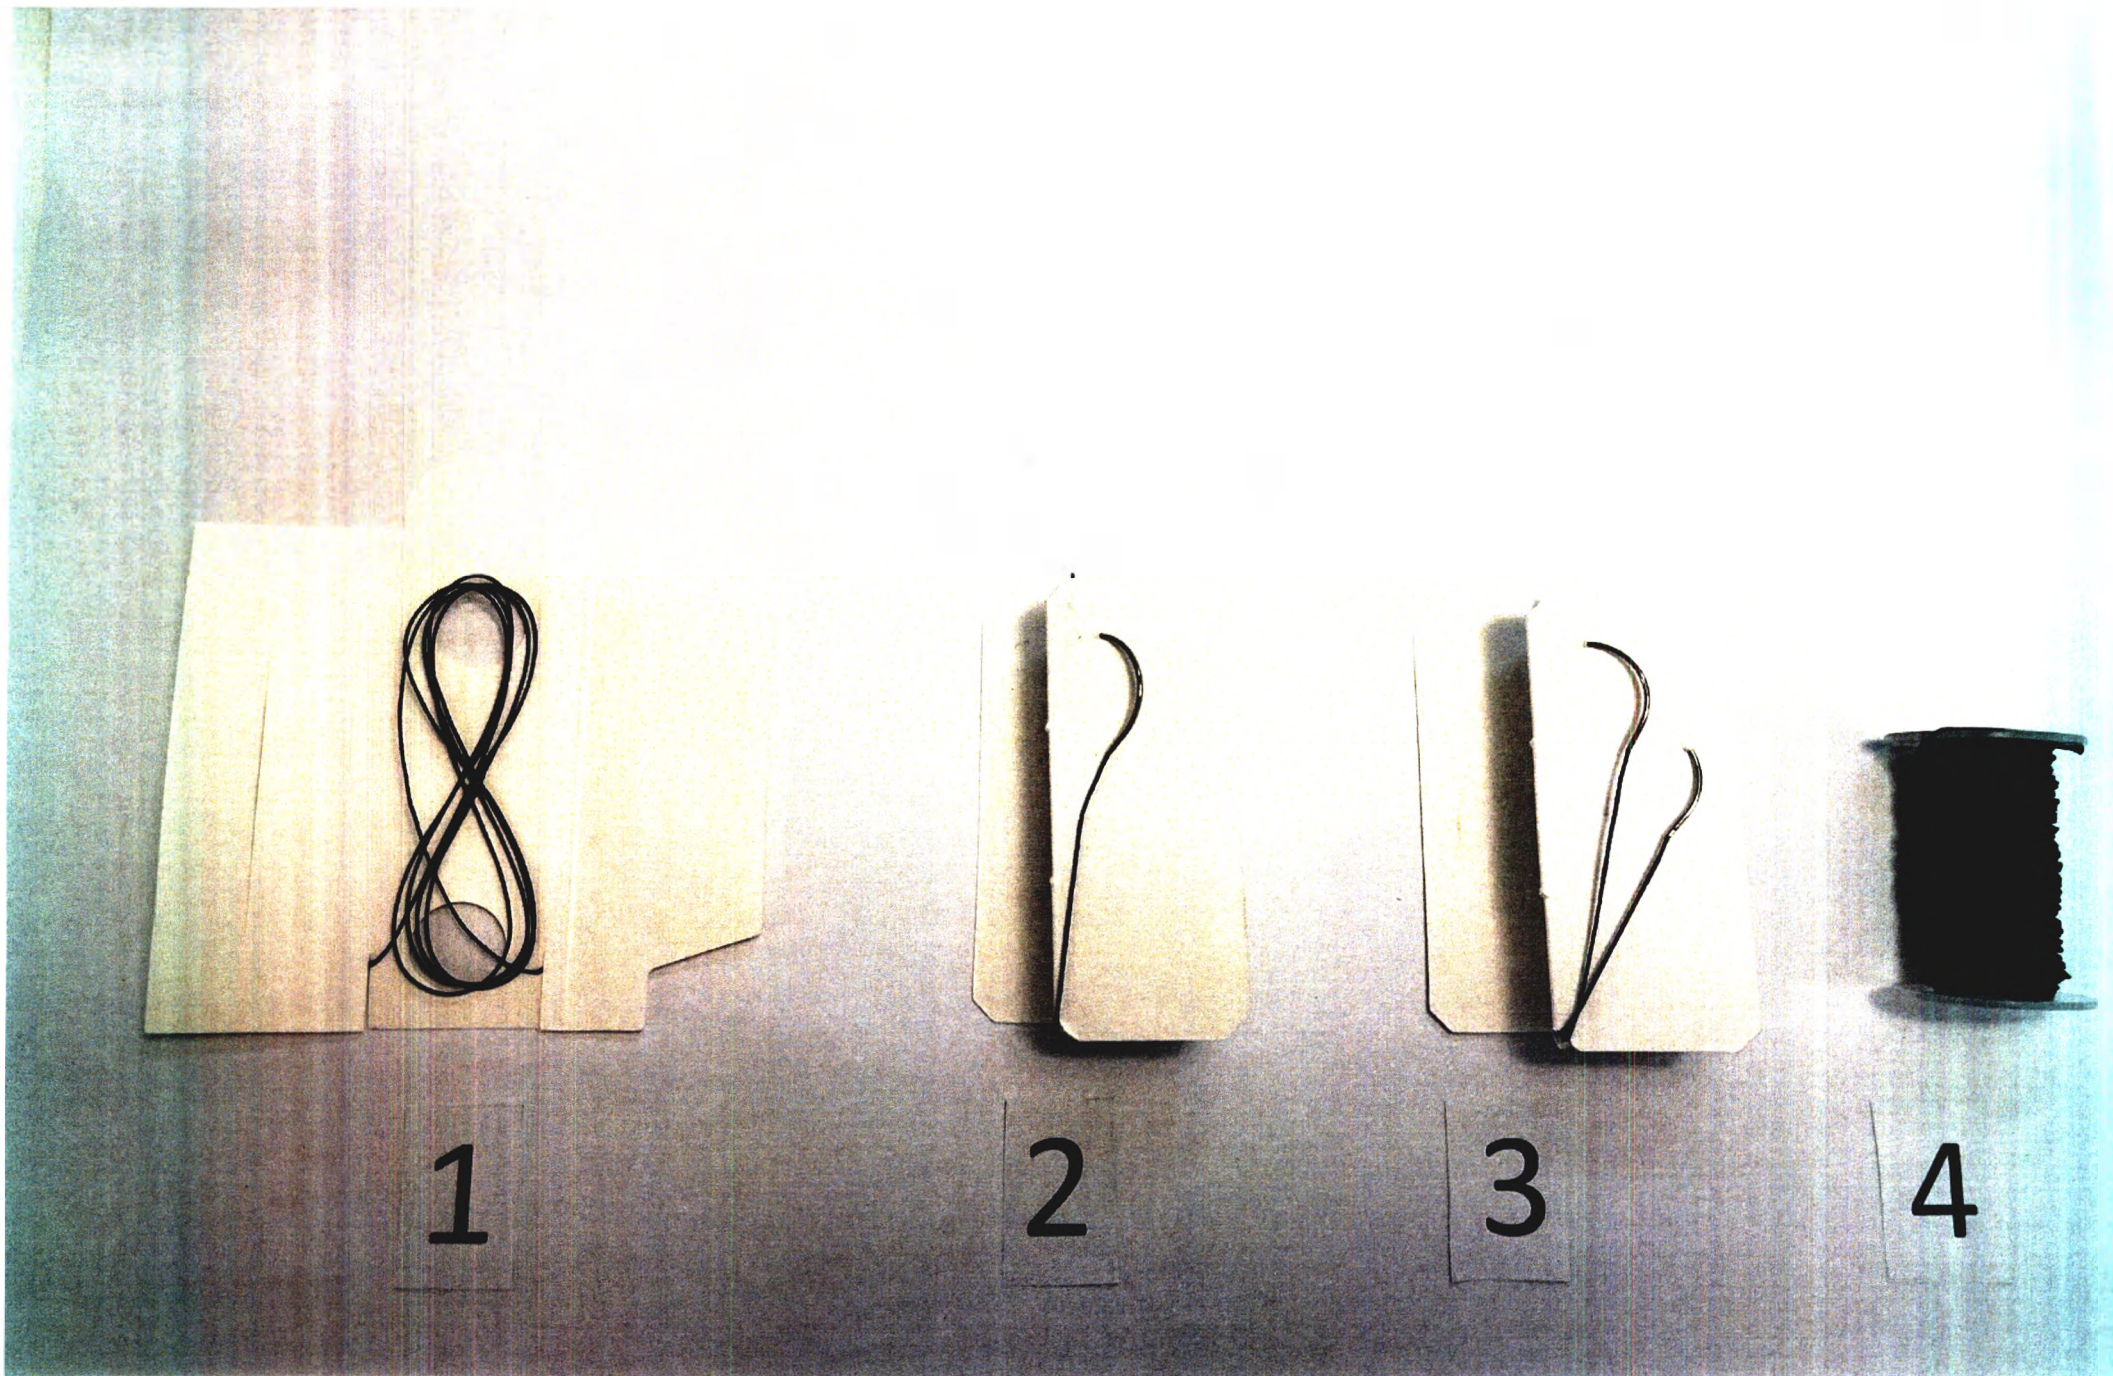


1 и 4 Нить шелковая крученая с силиконовым покрытием окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить шелковая крученая с силиконовым покрытием окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

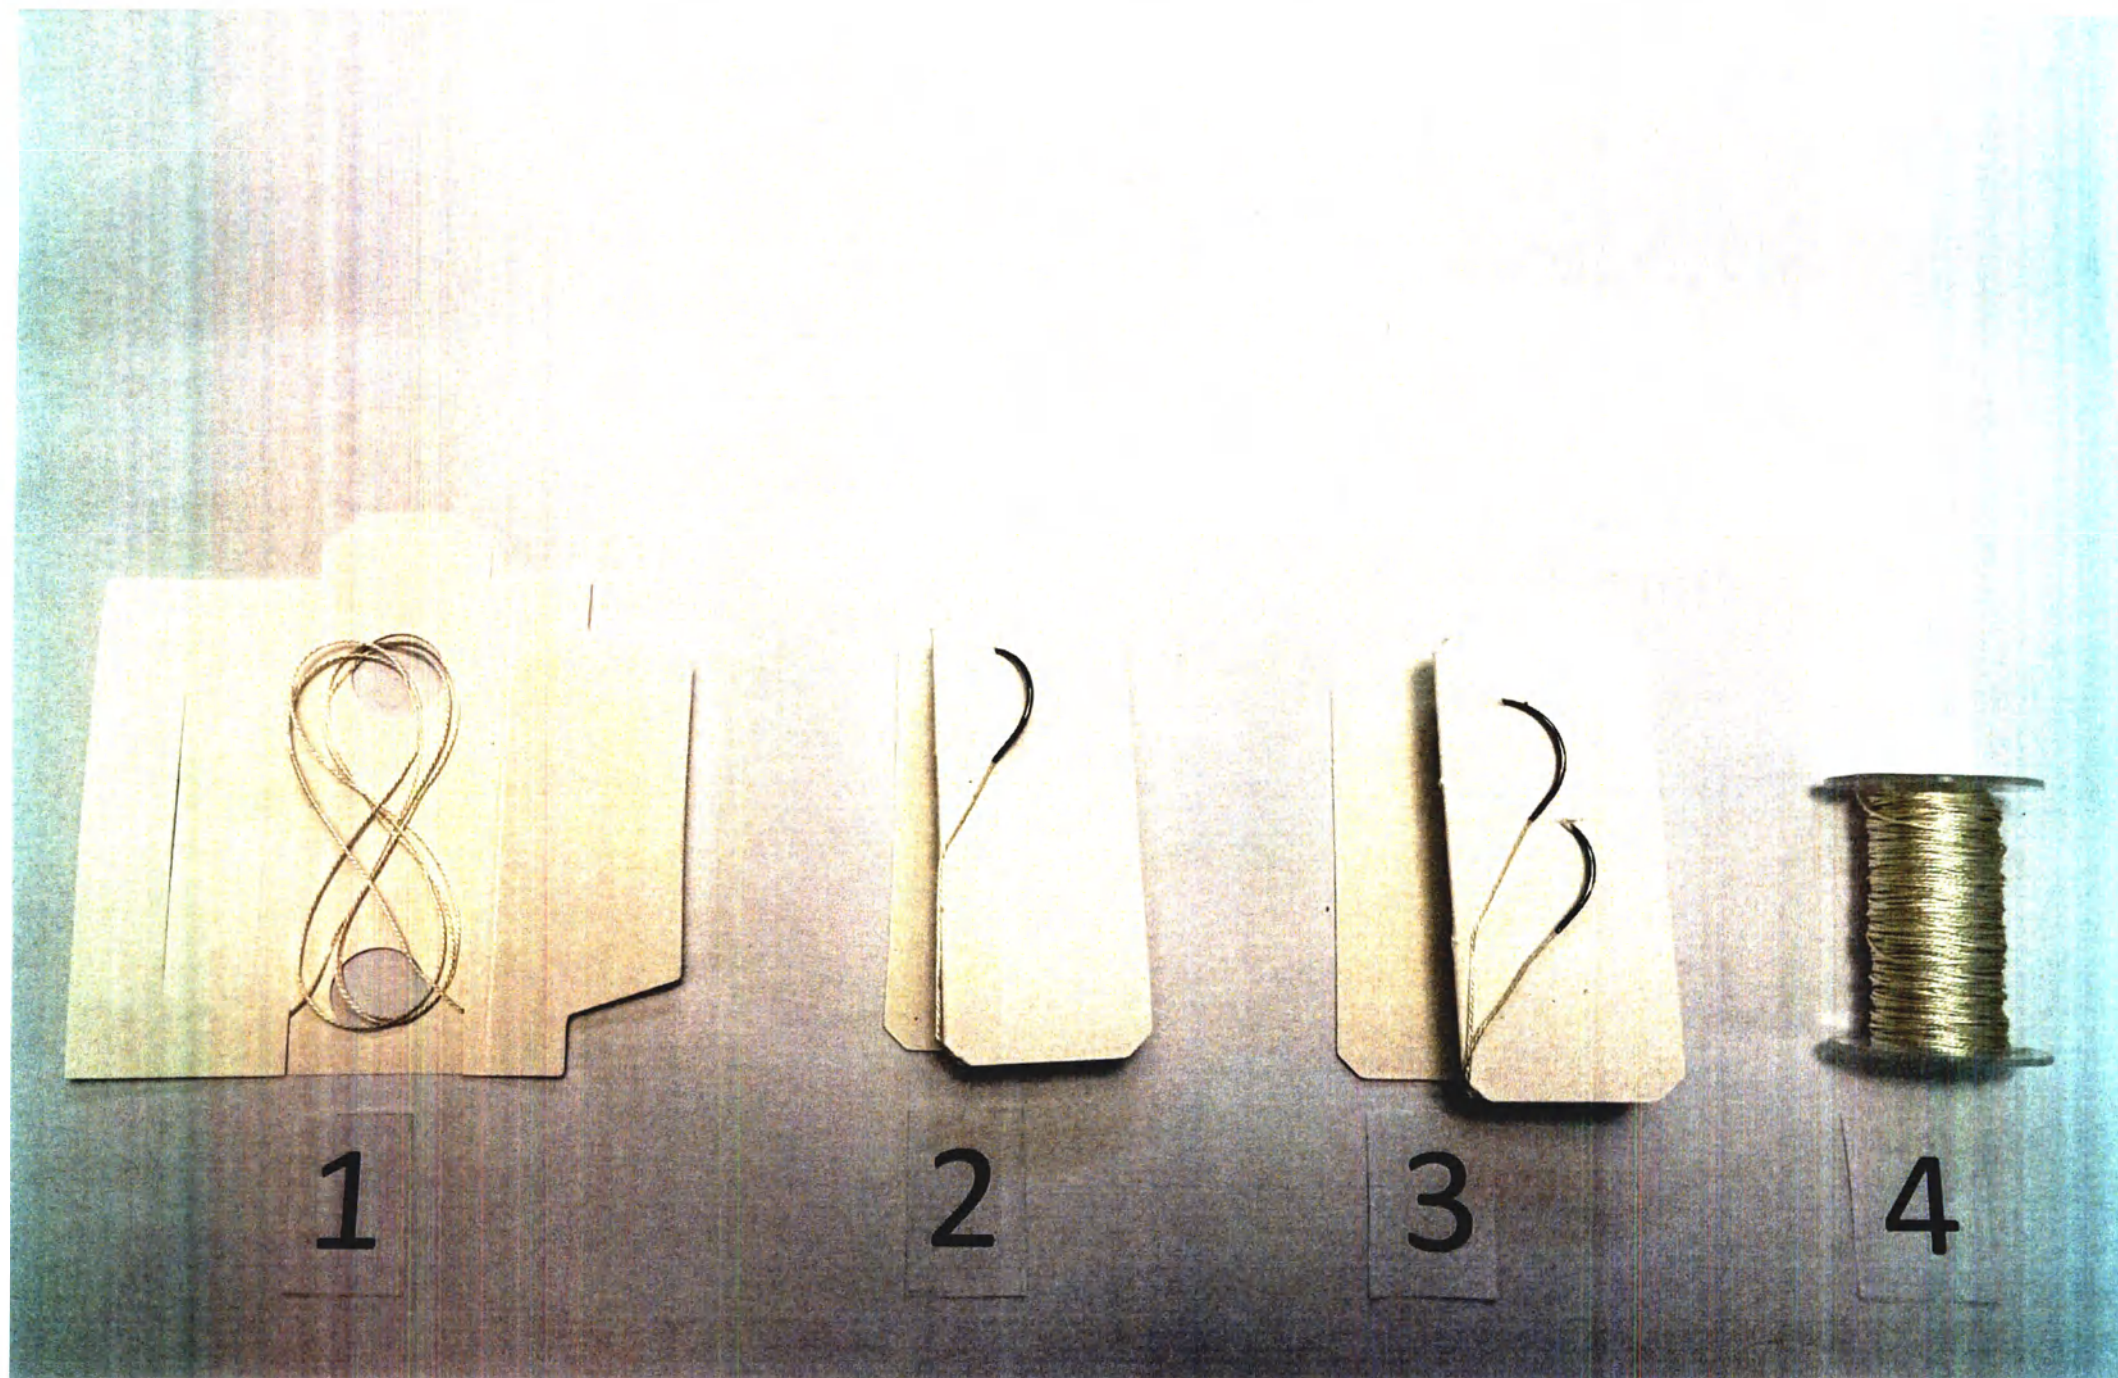


1 и 4 Нить шелковая крученая с покрытием воском неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить шелковая крученая с покрытием воском неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

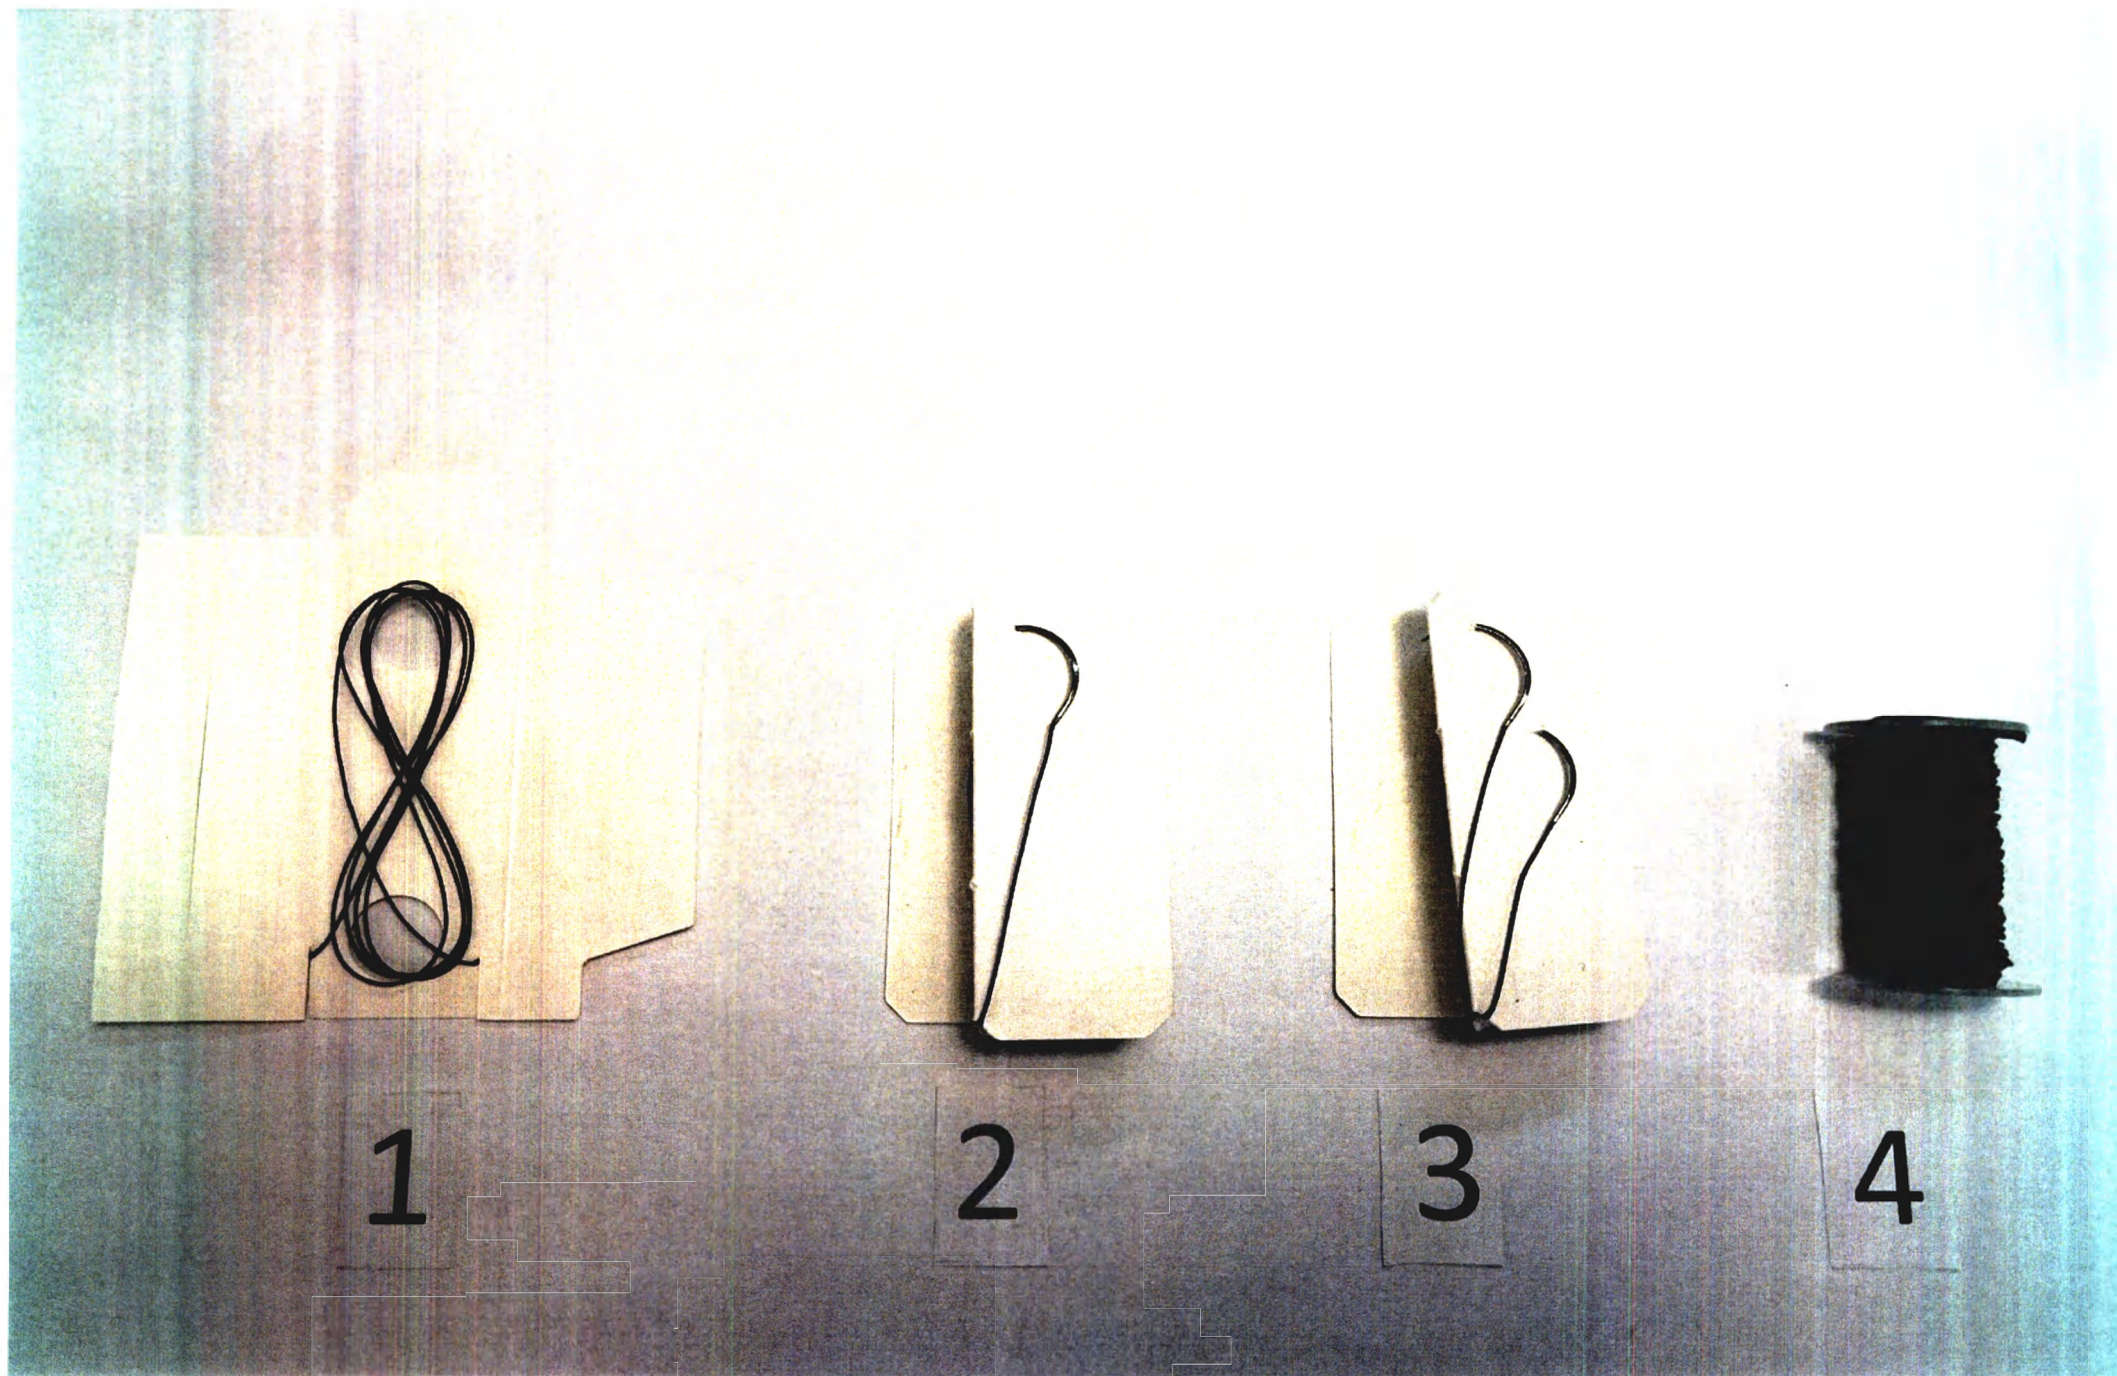


1 и 4 Нить шелковая крученая с покрытием воском окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить шелковая крученая с покрытием воском окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

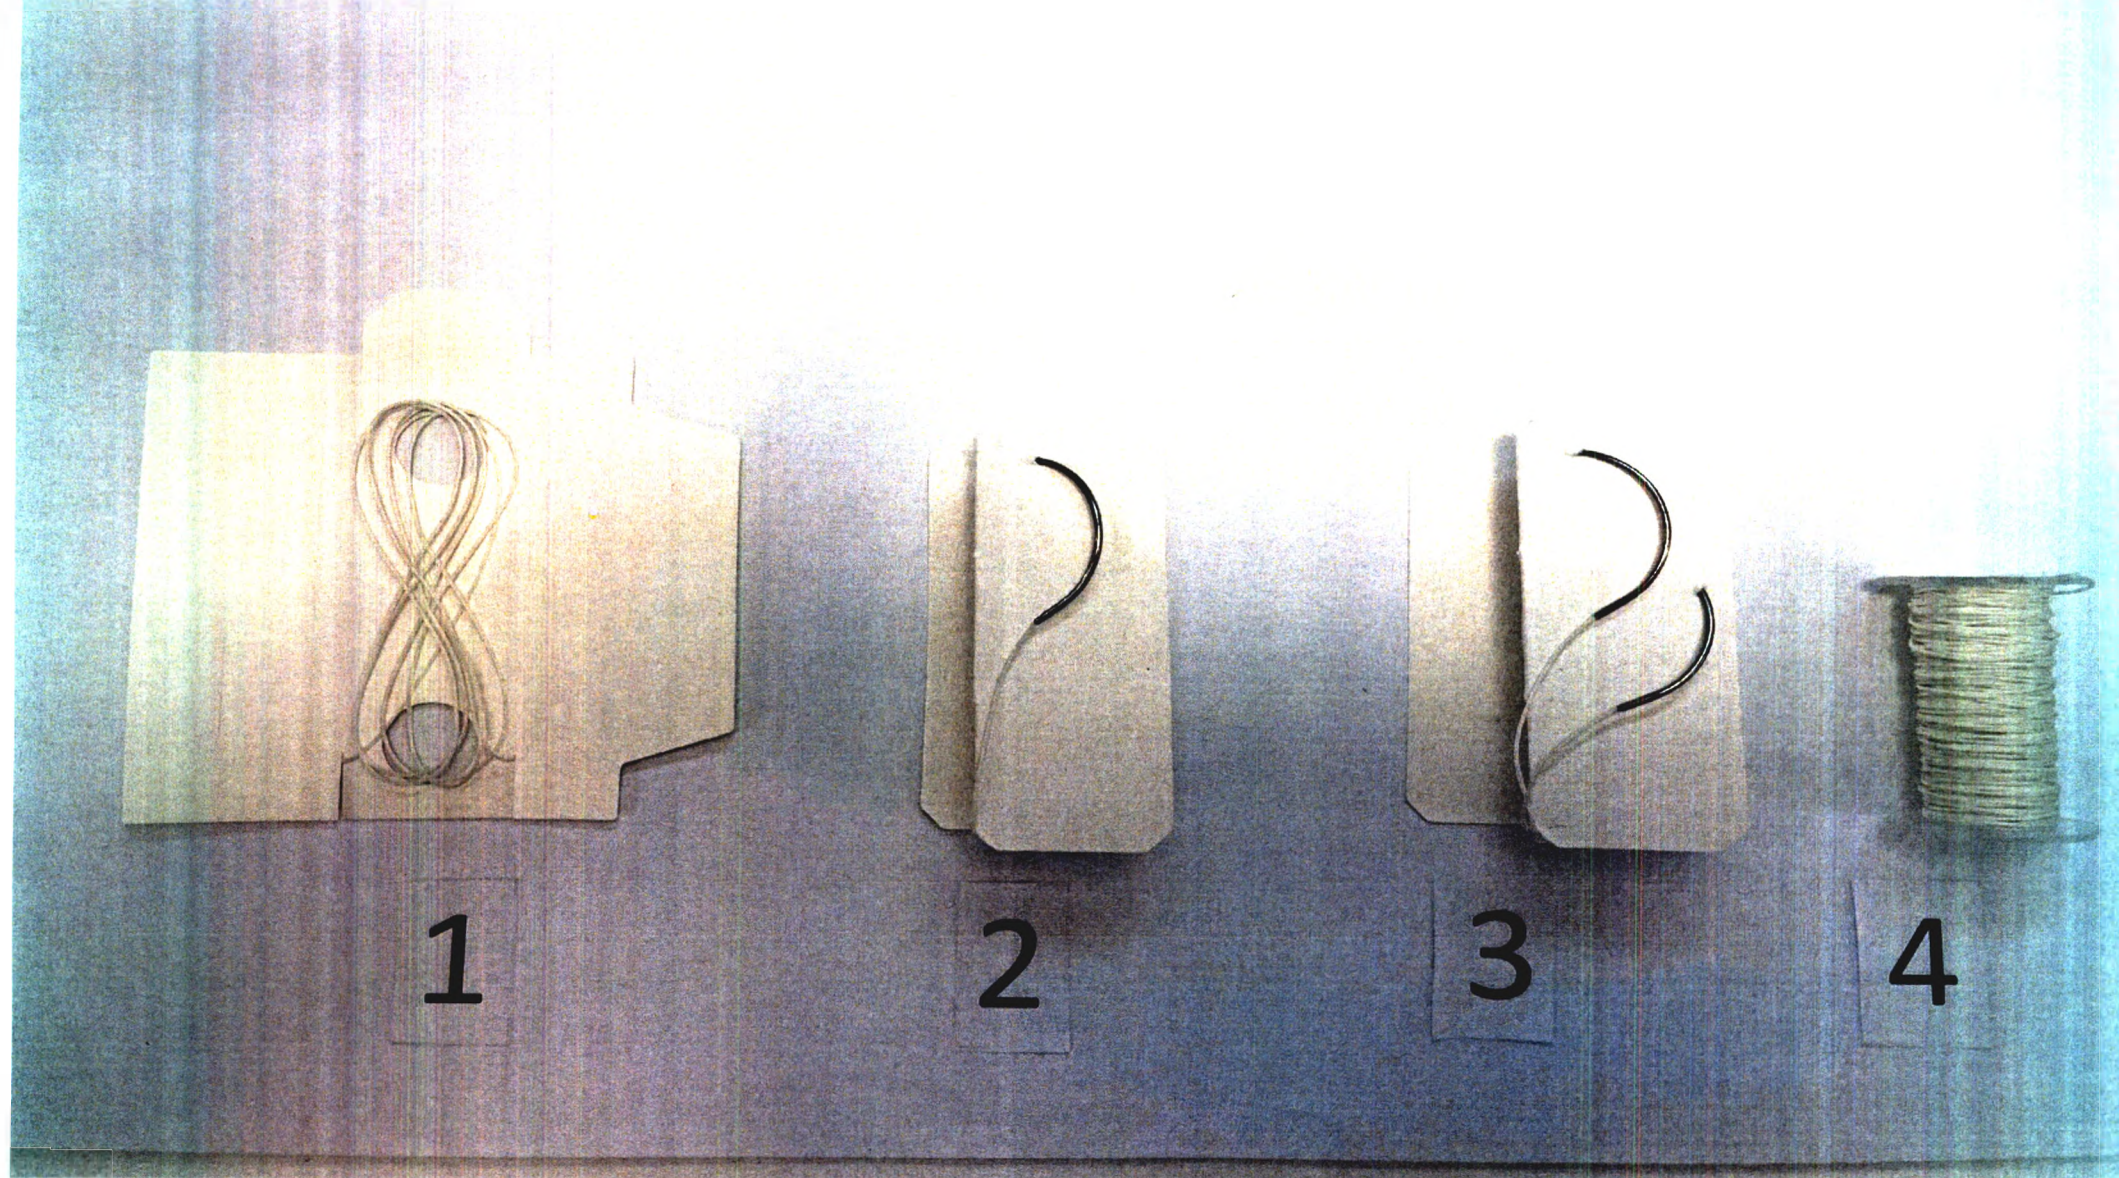


1 и 4 Нить шелковая плетеная неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)
2 и 3 Нить шелковая плетеная неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

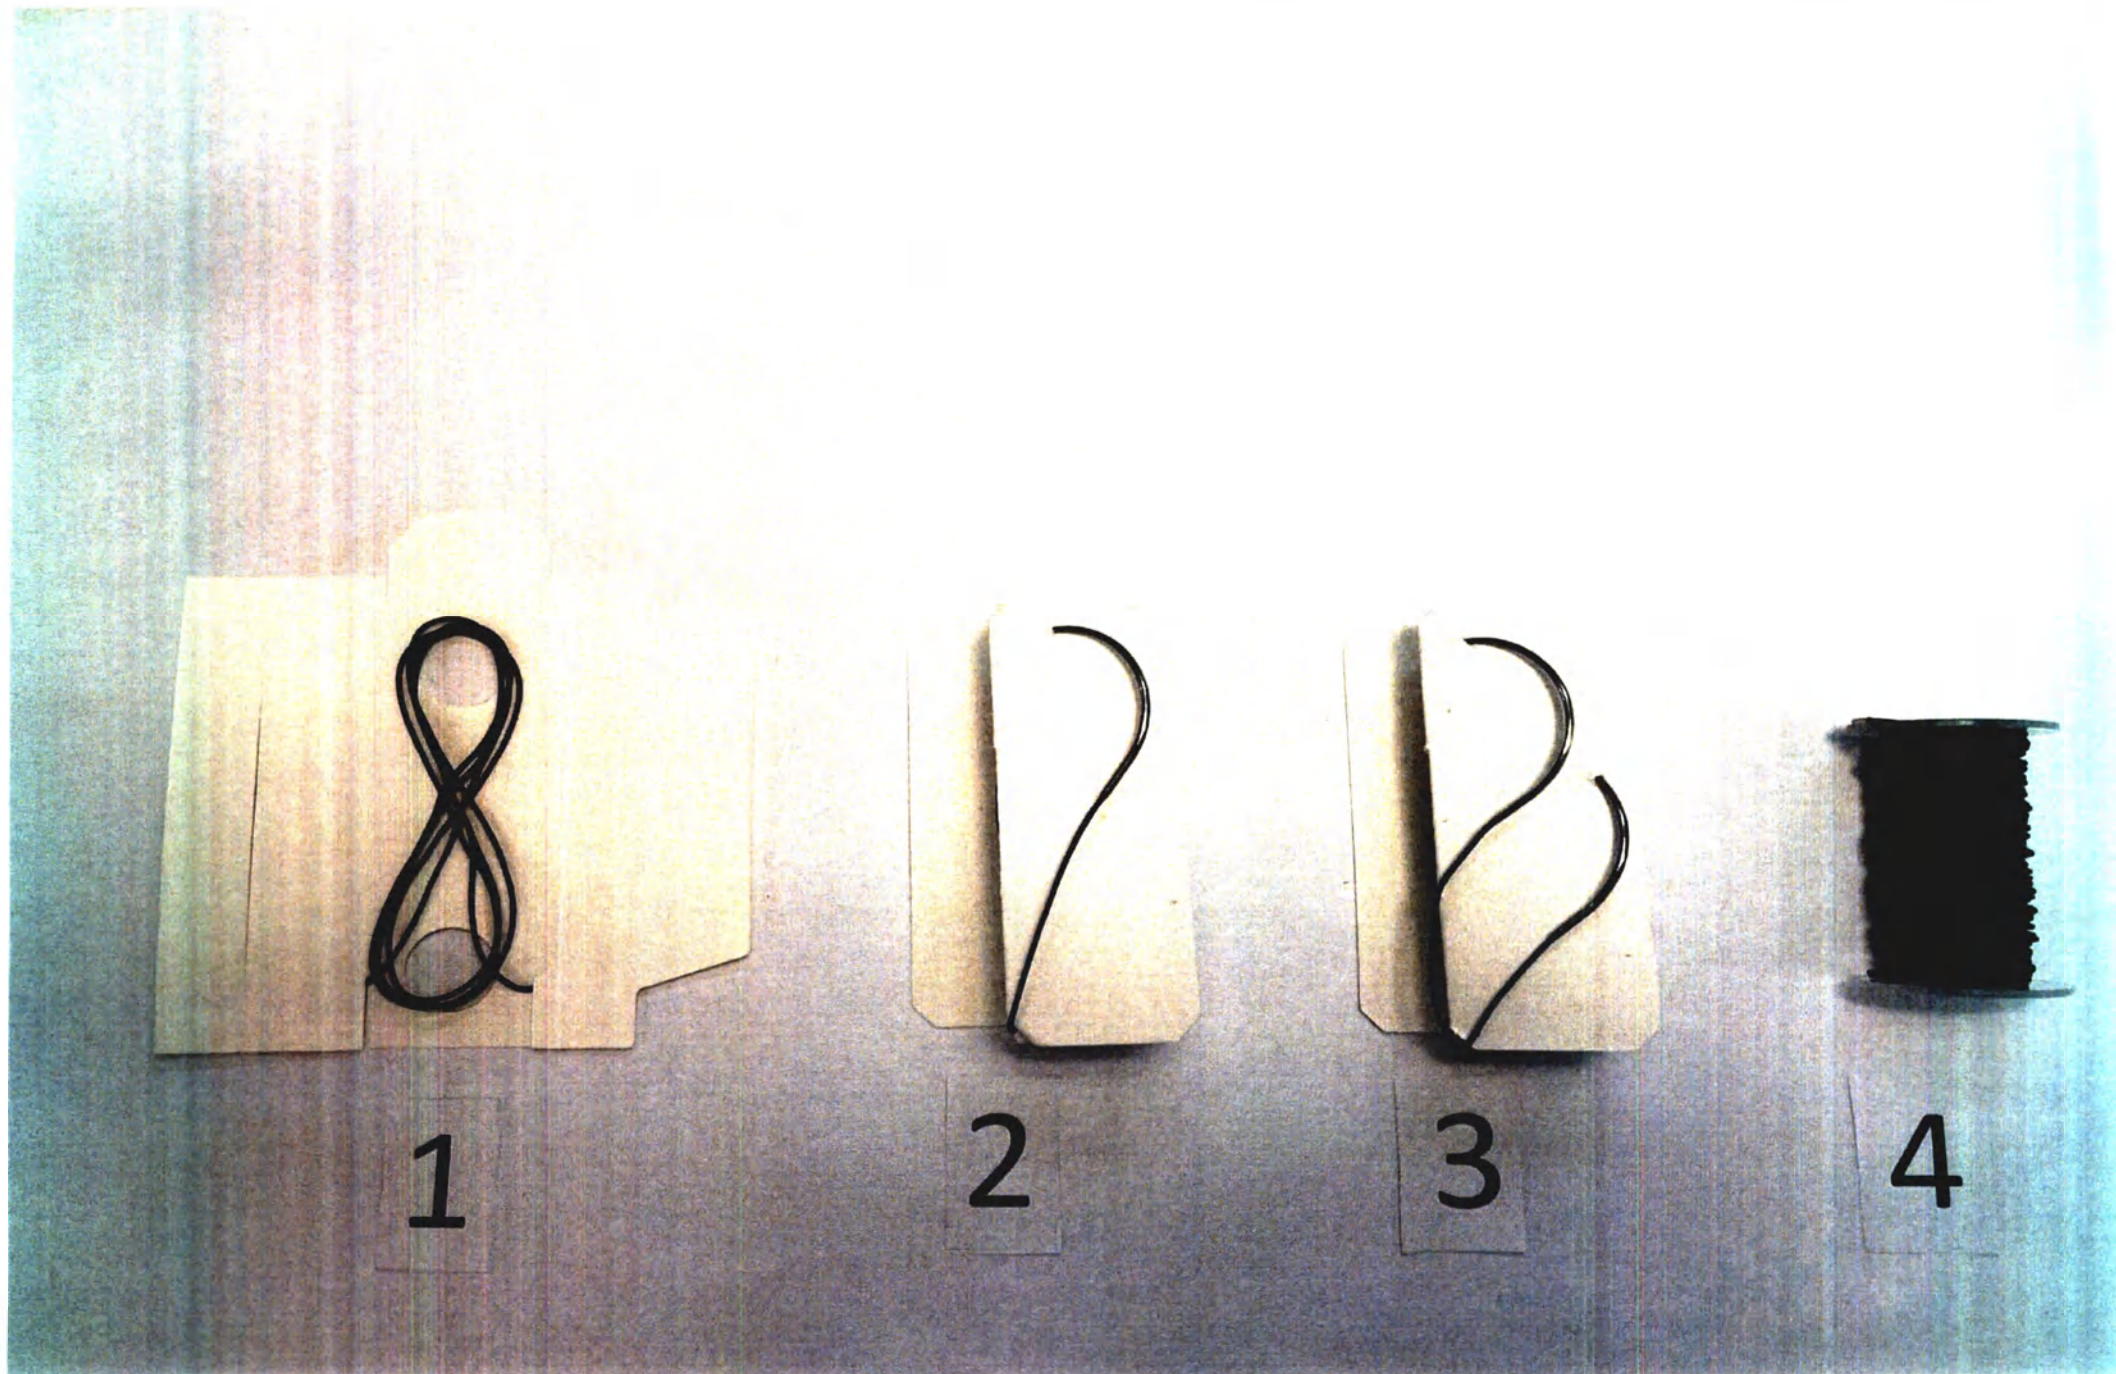


1 и 4 Нить шелковая плетеная окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить шелковая плетеная окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

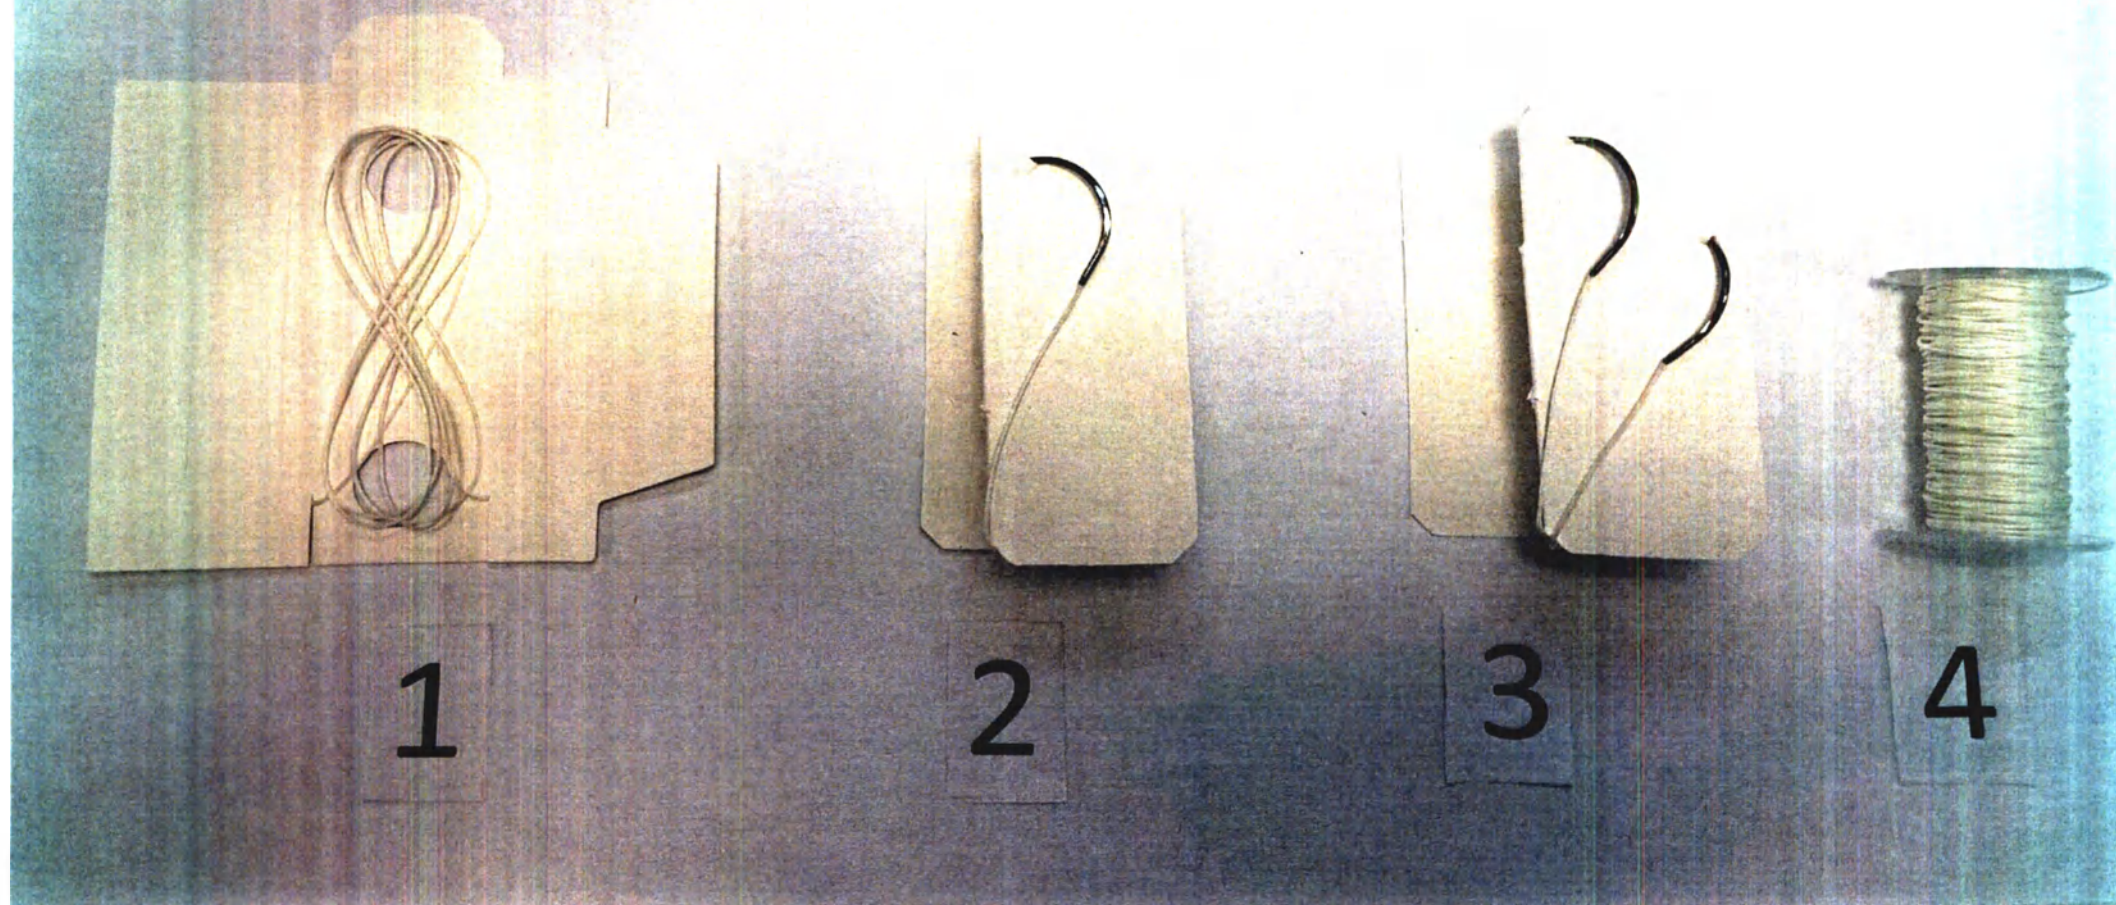


1 и 4 Нить шелковая плетеная с силиконовым покрытием неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить шелковая плетеная с силиконовым покрытием неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

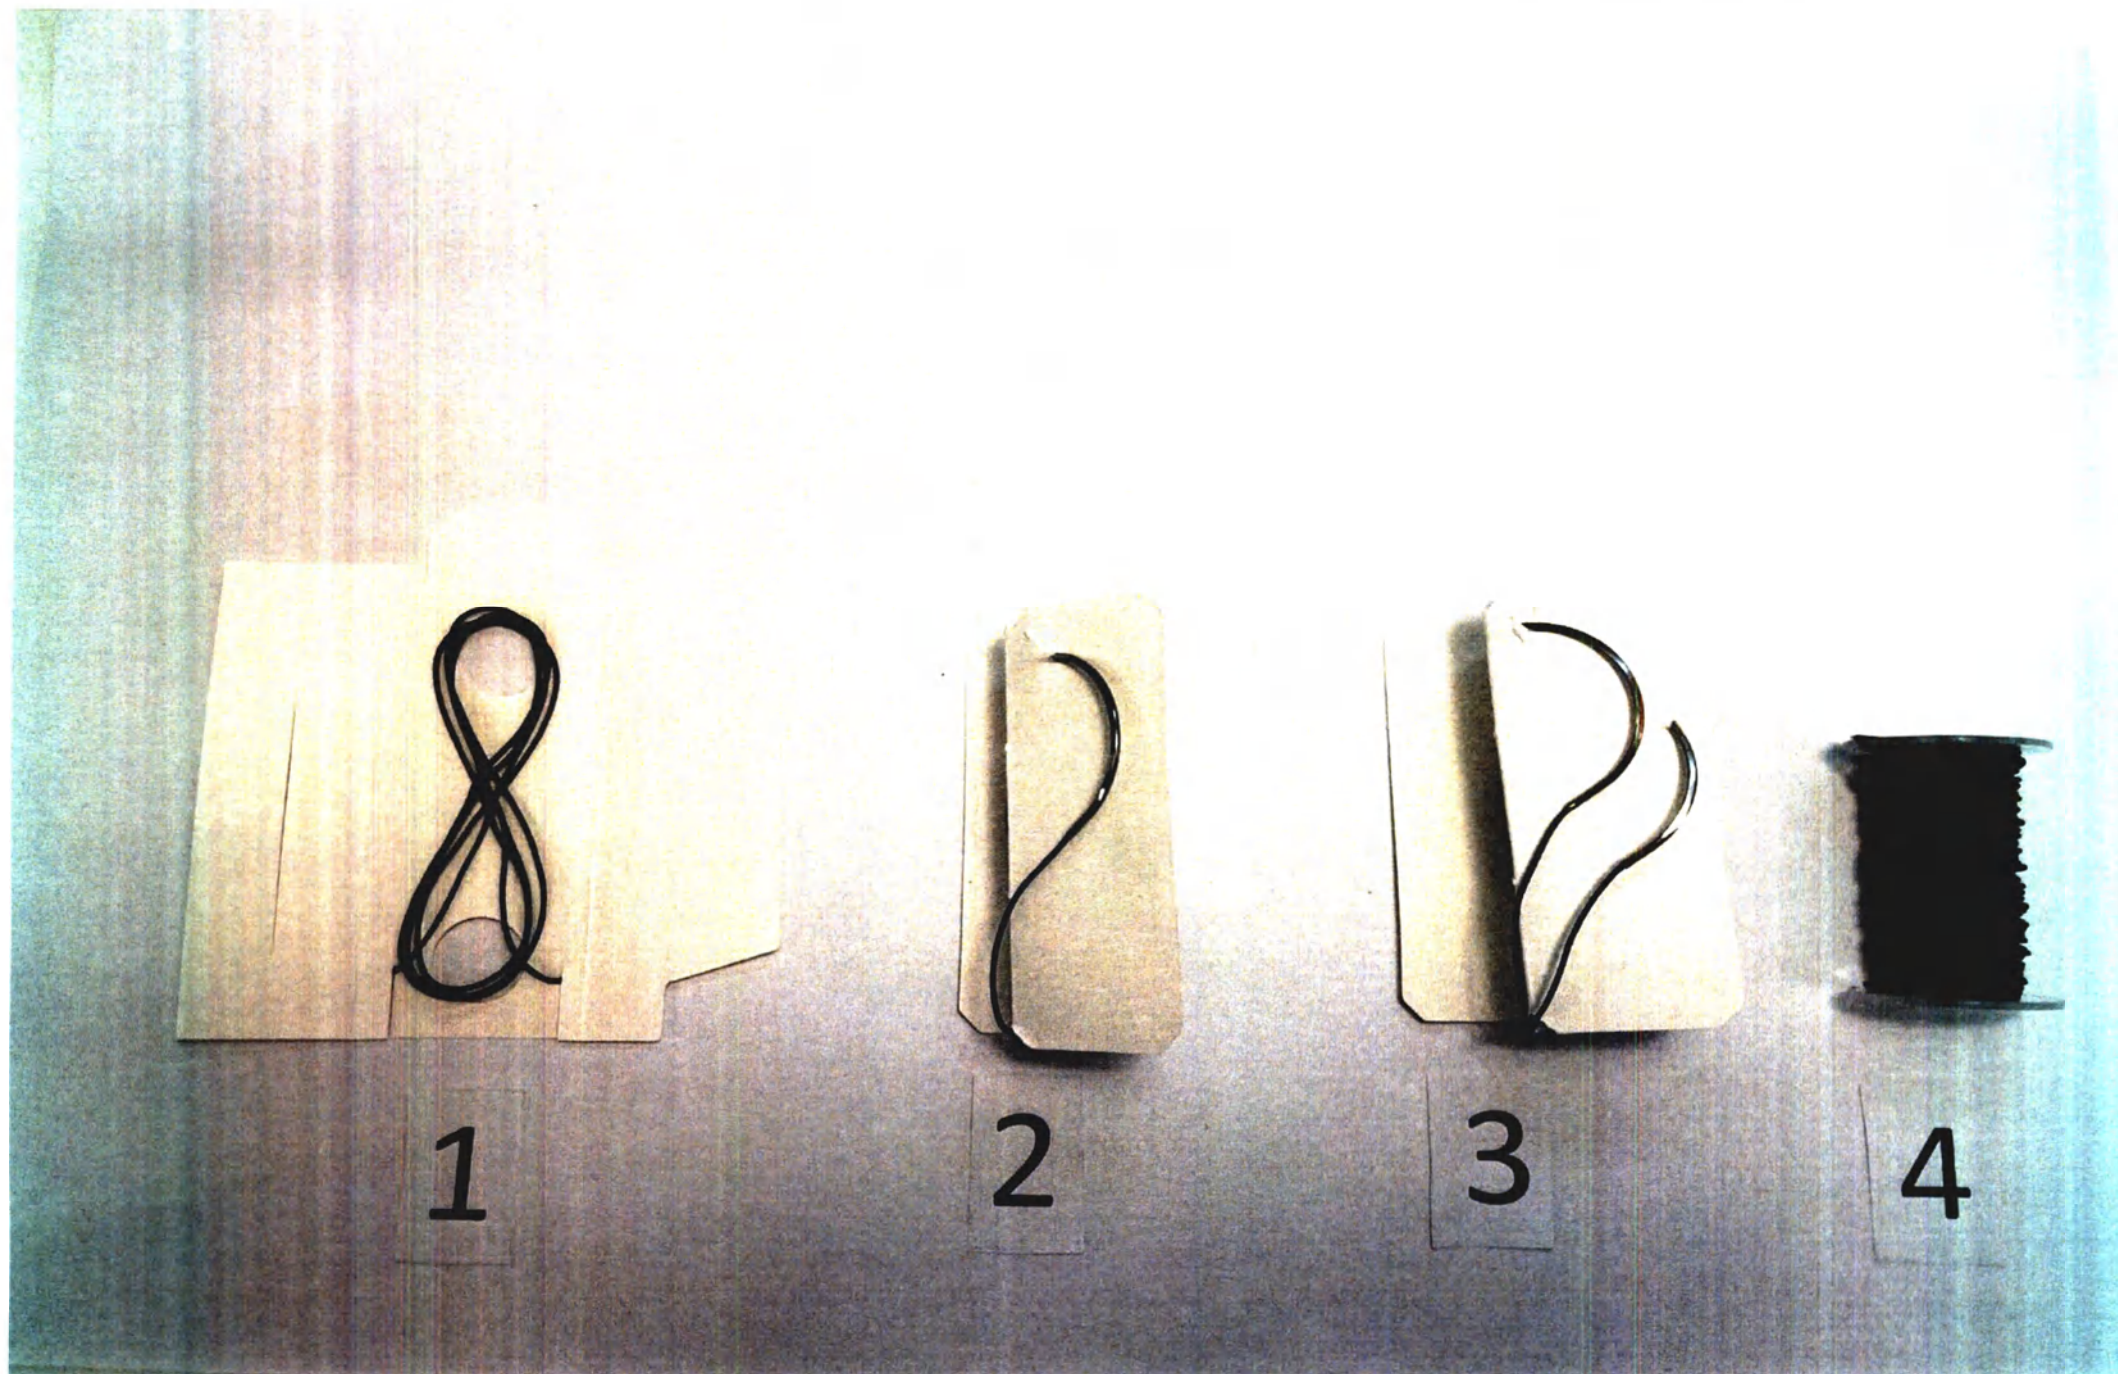


1 и 4 Нить шелковая плетеная с силиконовым покрытием окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить шелковая плетеная с силиконовым покрытием окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

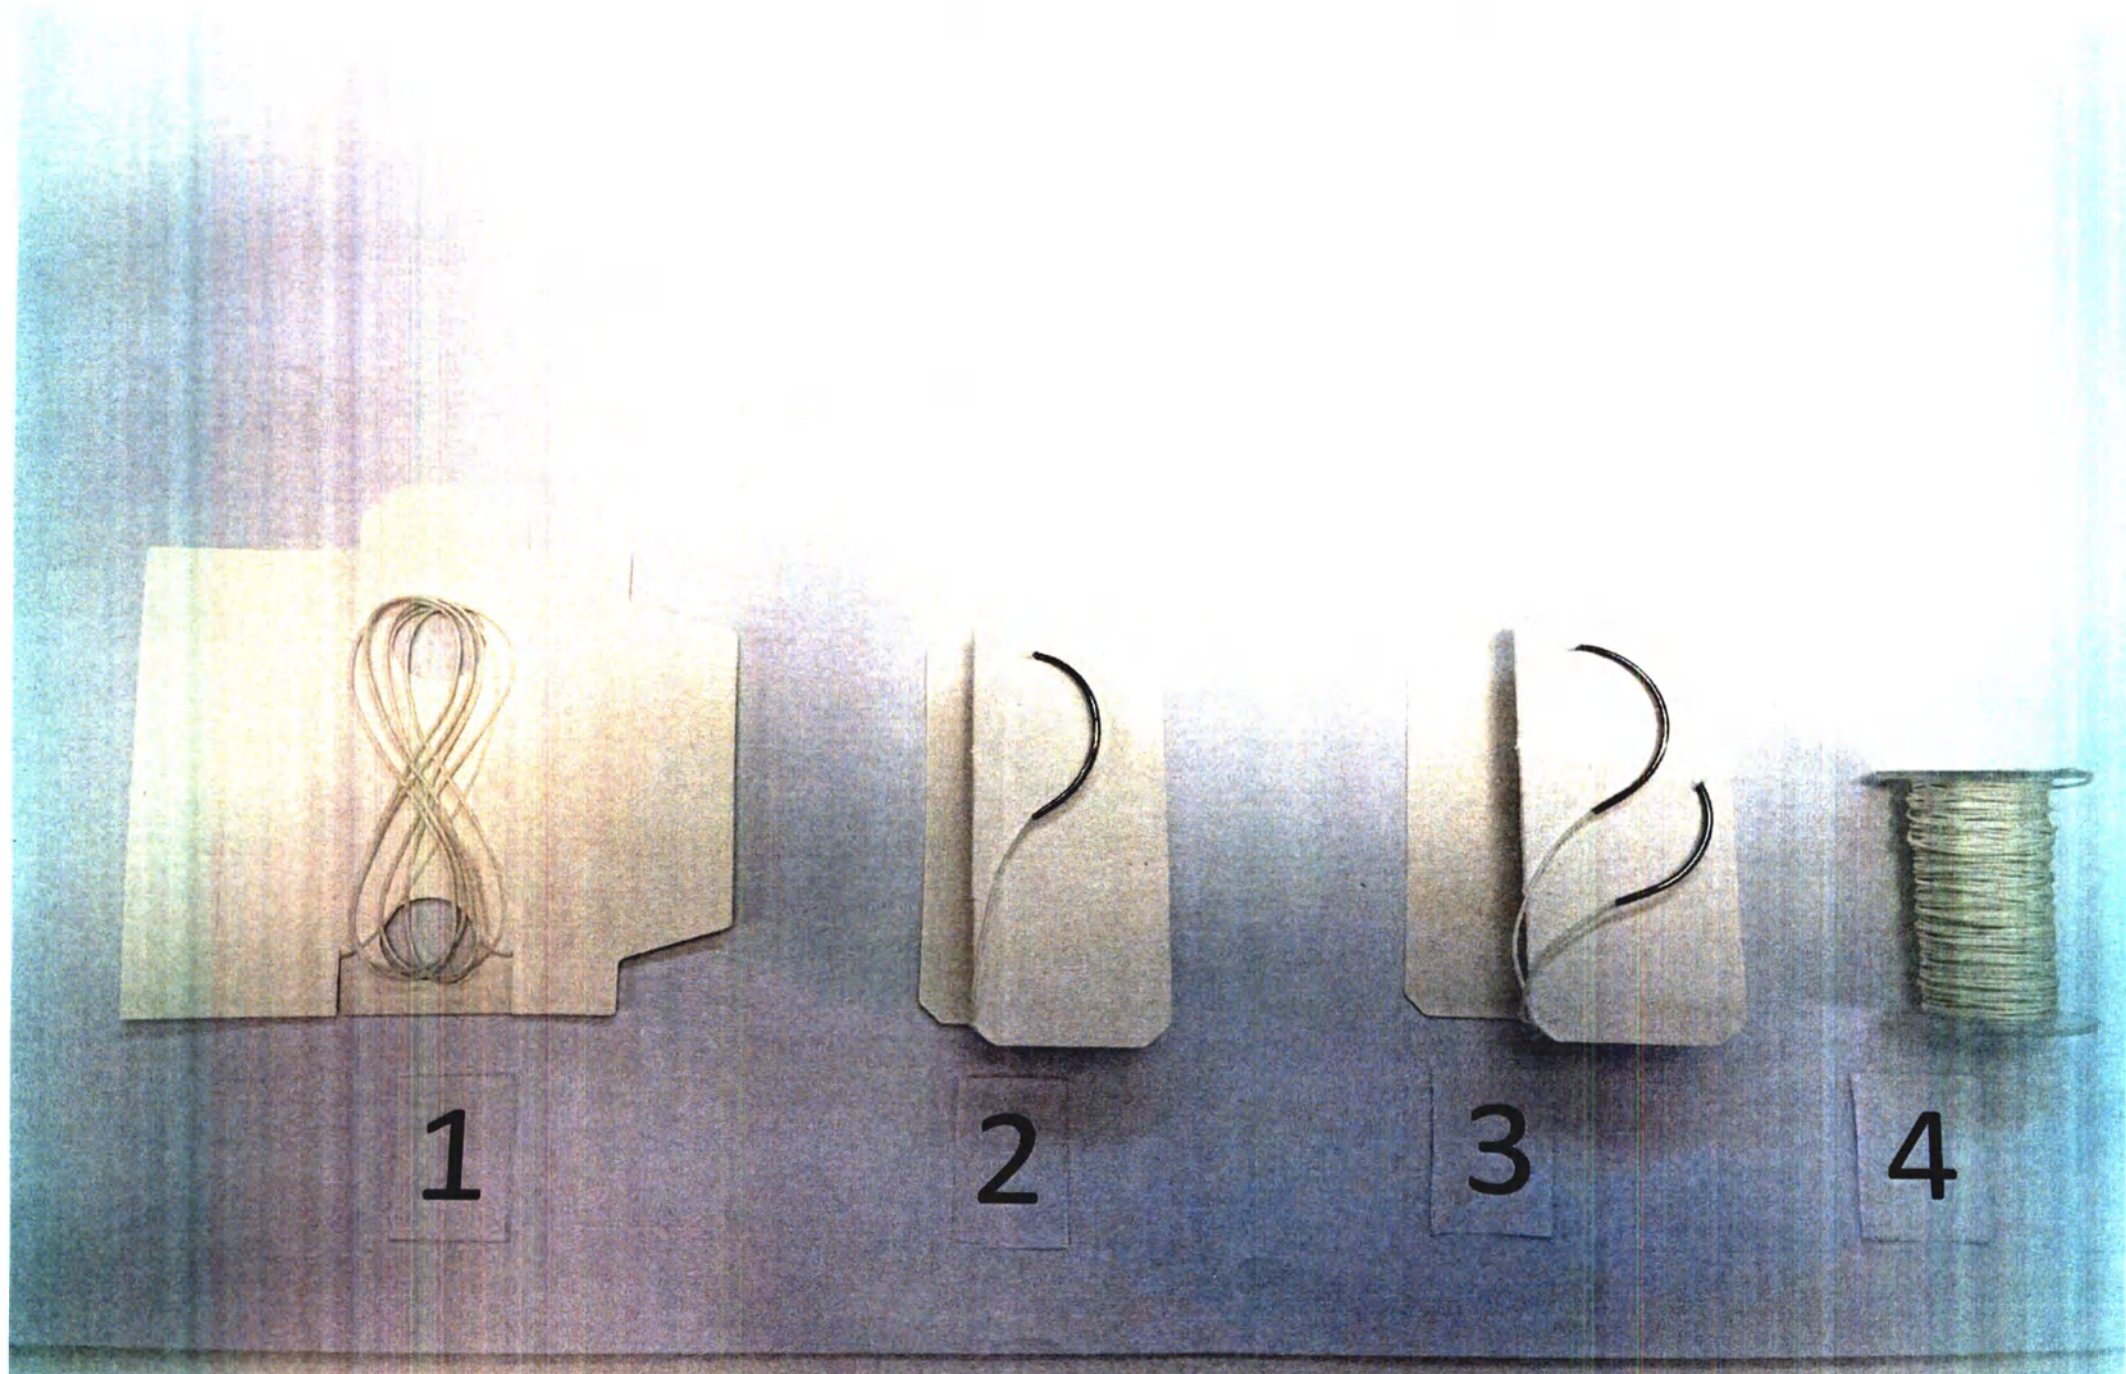


1 и 4 Нить шелковая плетеная с покрытием воском неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить шелковая плетеная с покрытием воском неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

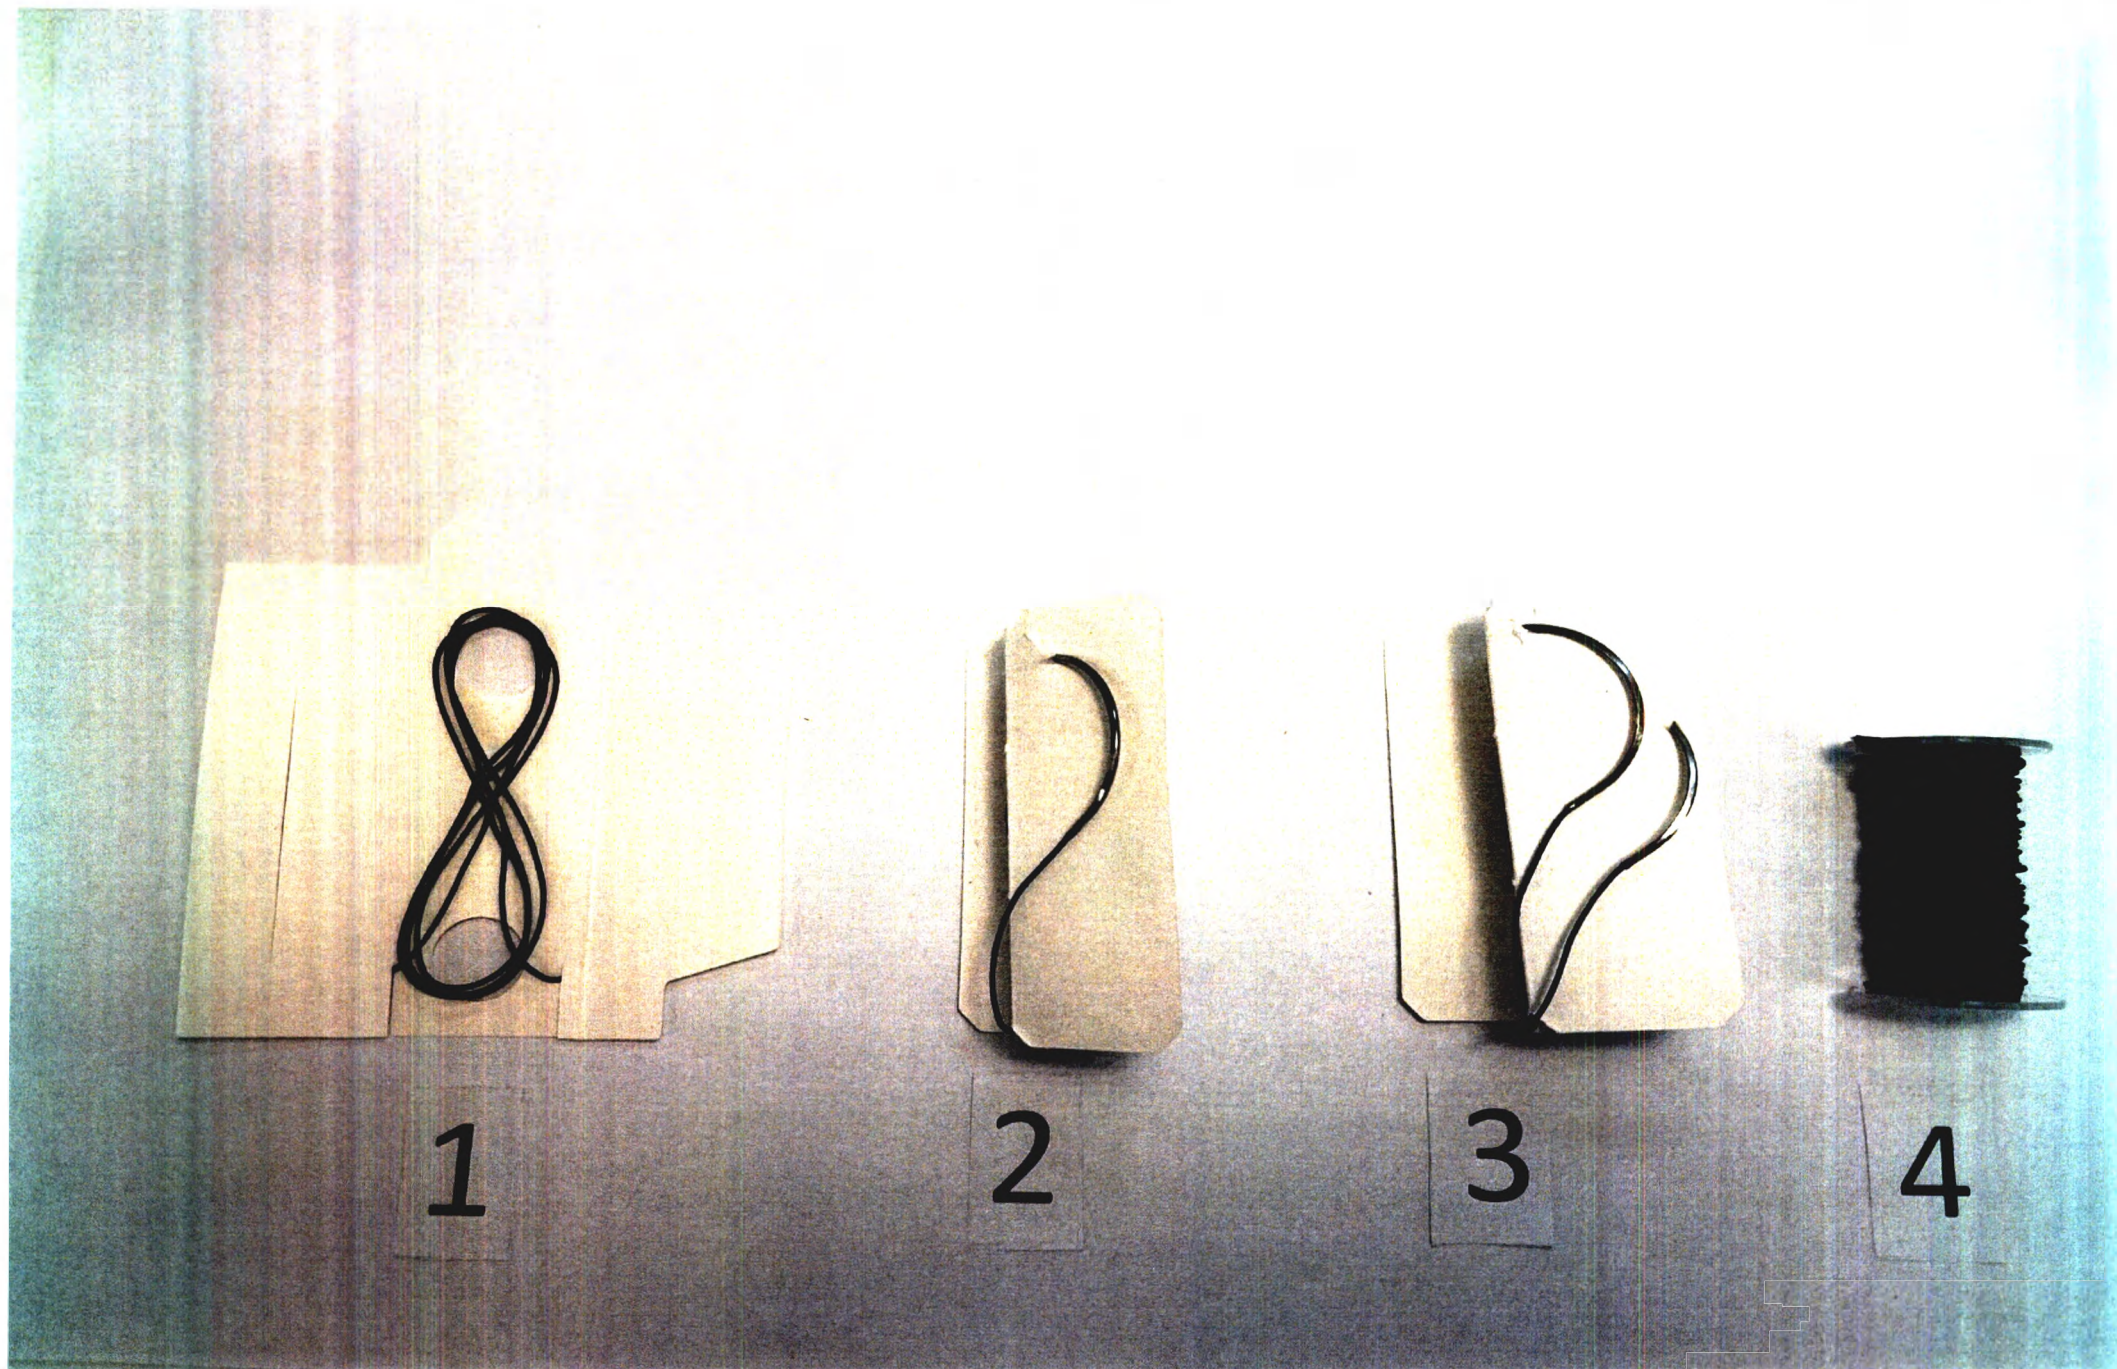


1 и 4 Нить шелковая плетеная с покрытием воском окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)

2 и 3 Нить шелковая плетеная с покрытием воском окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

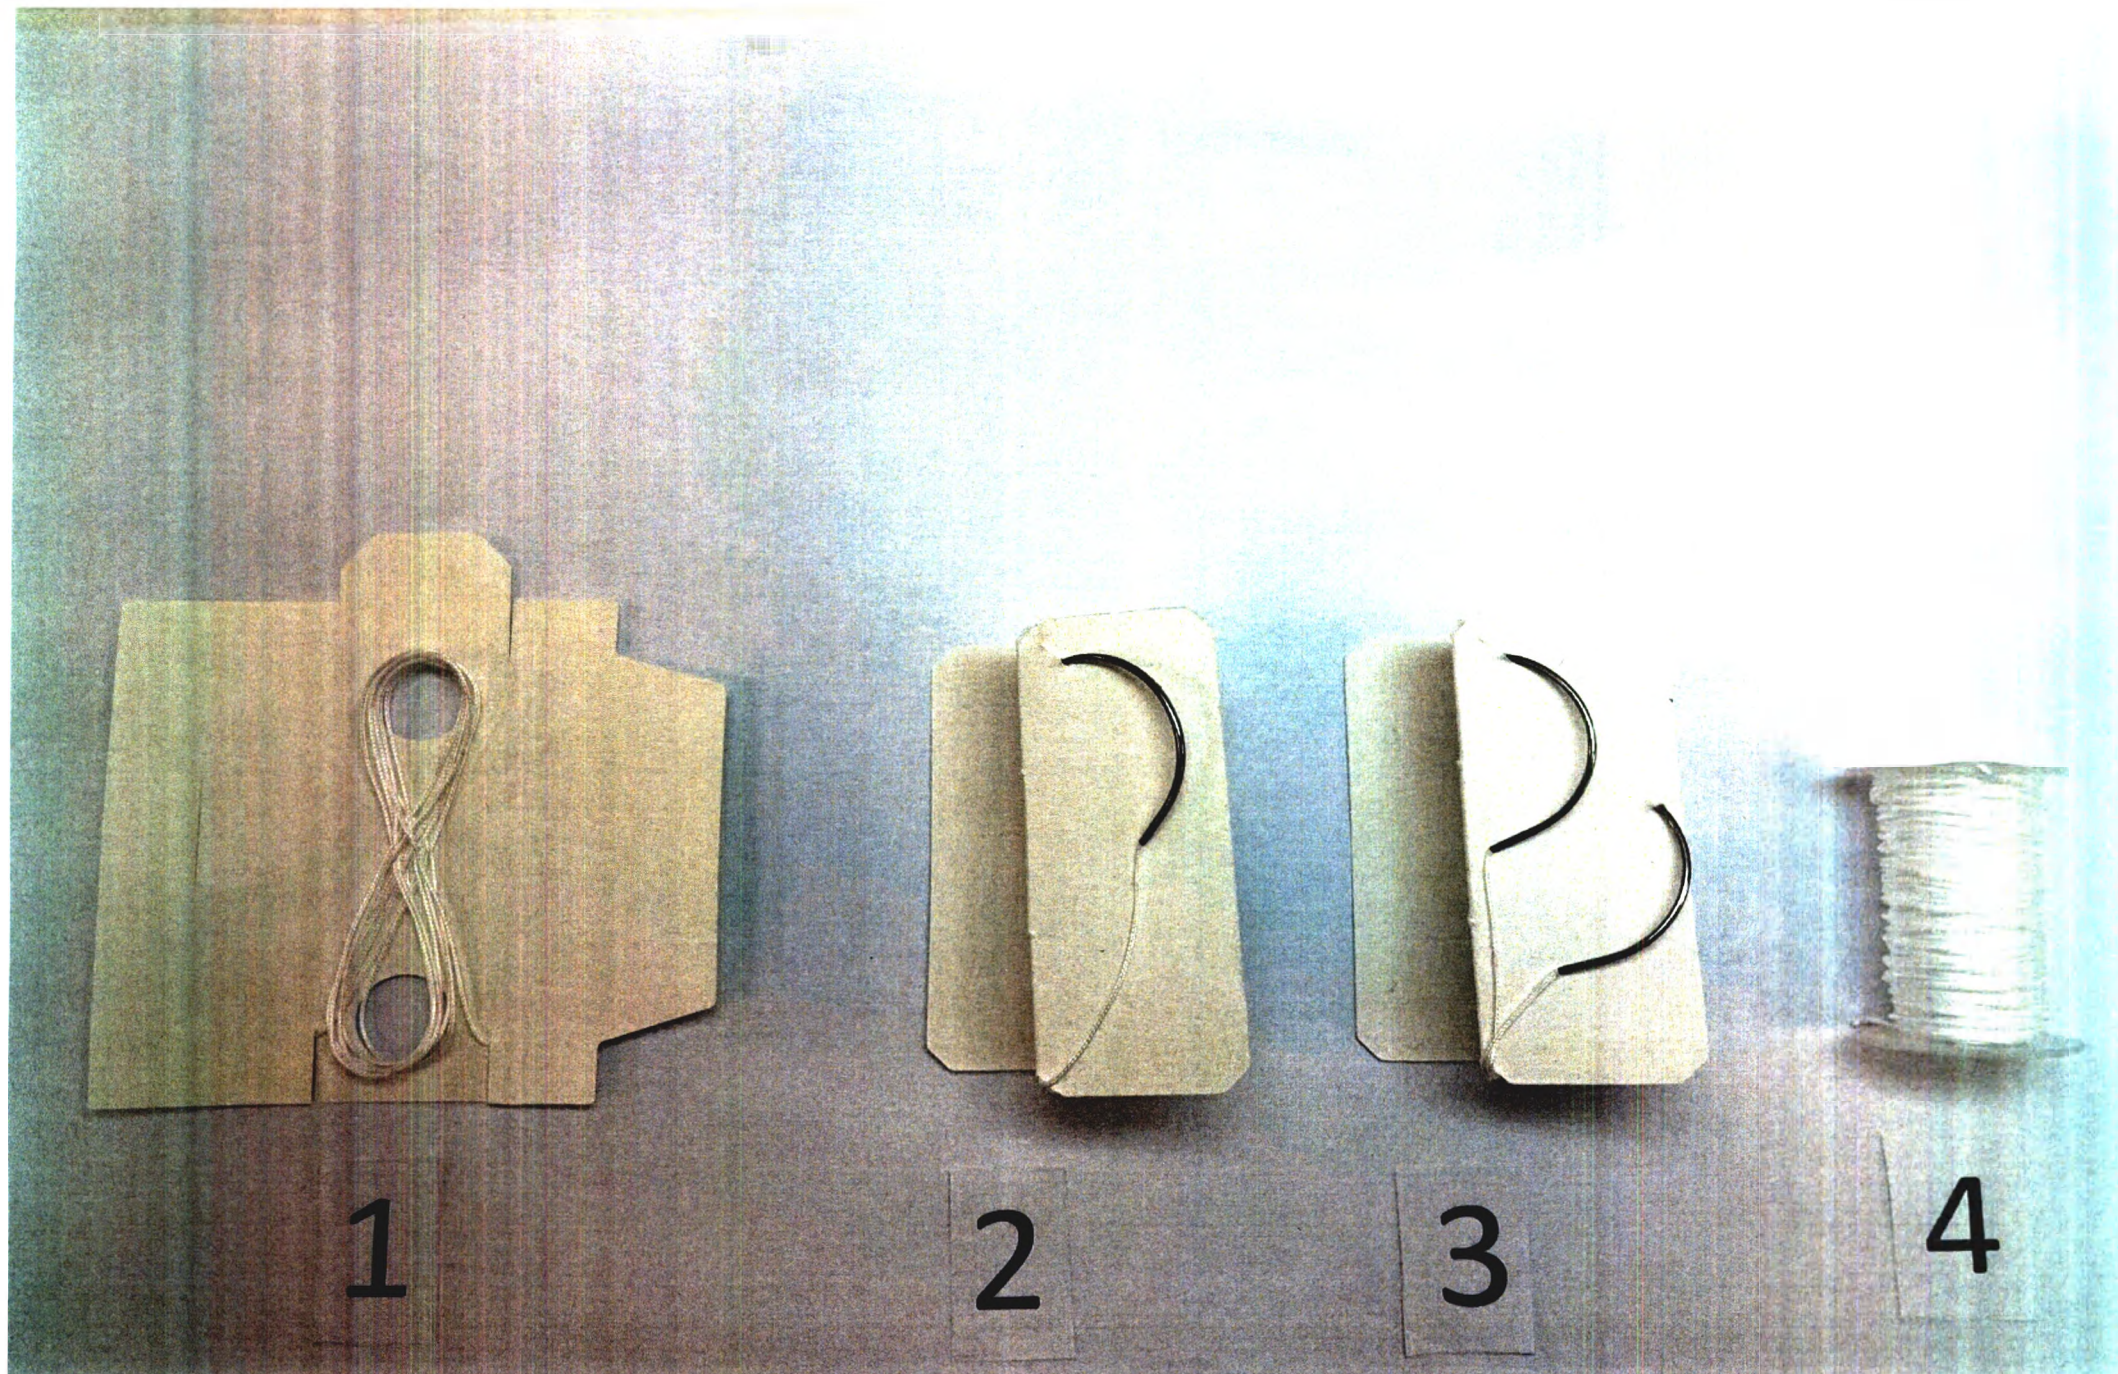


1 и 4 Нить полиолефиновая плетеная неокрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1- в отрезке, 4 - на катушке)


2 и 3 Нить полиолефиновая плетеная неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

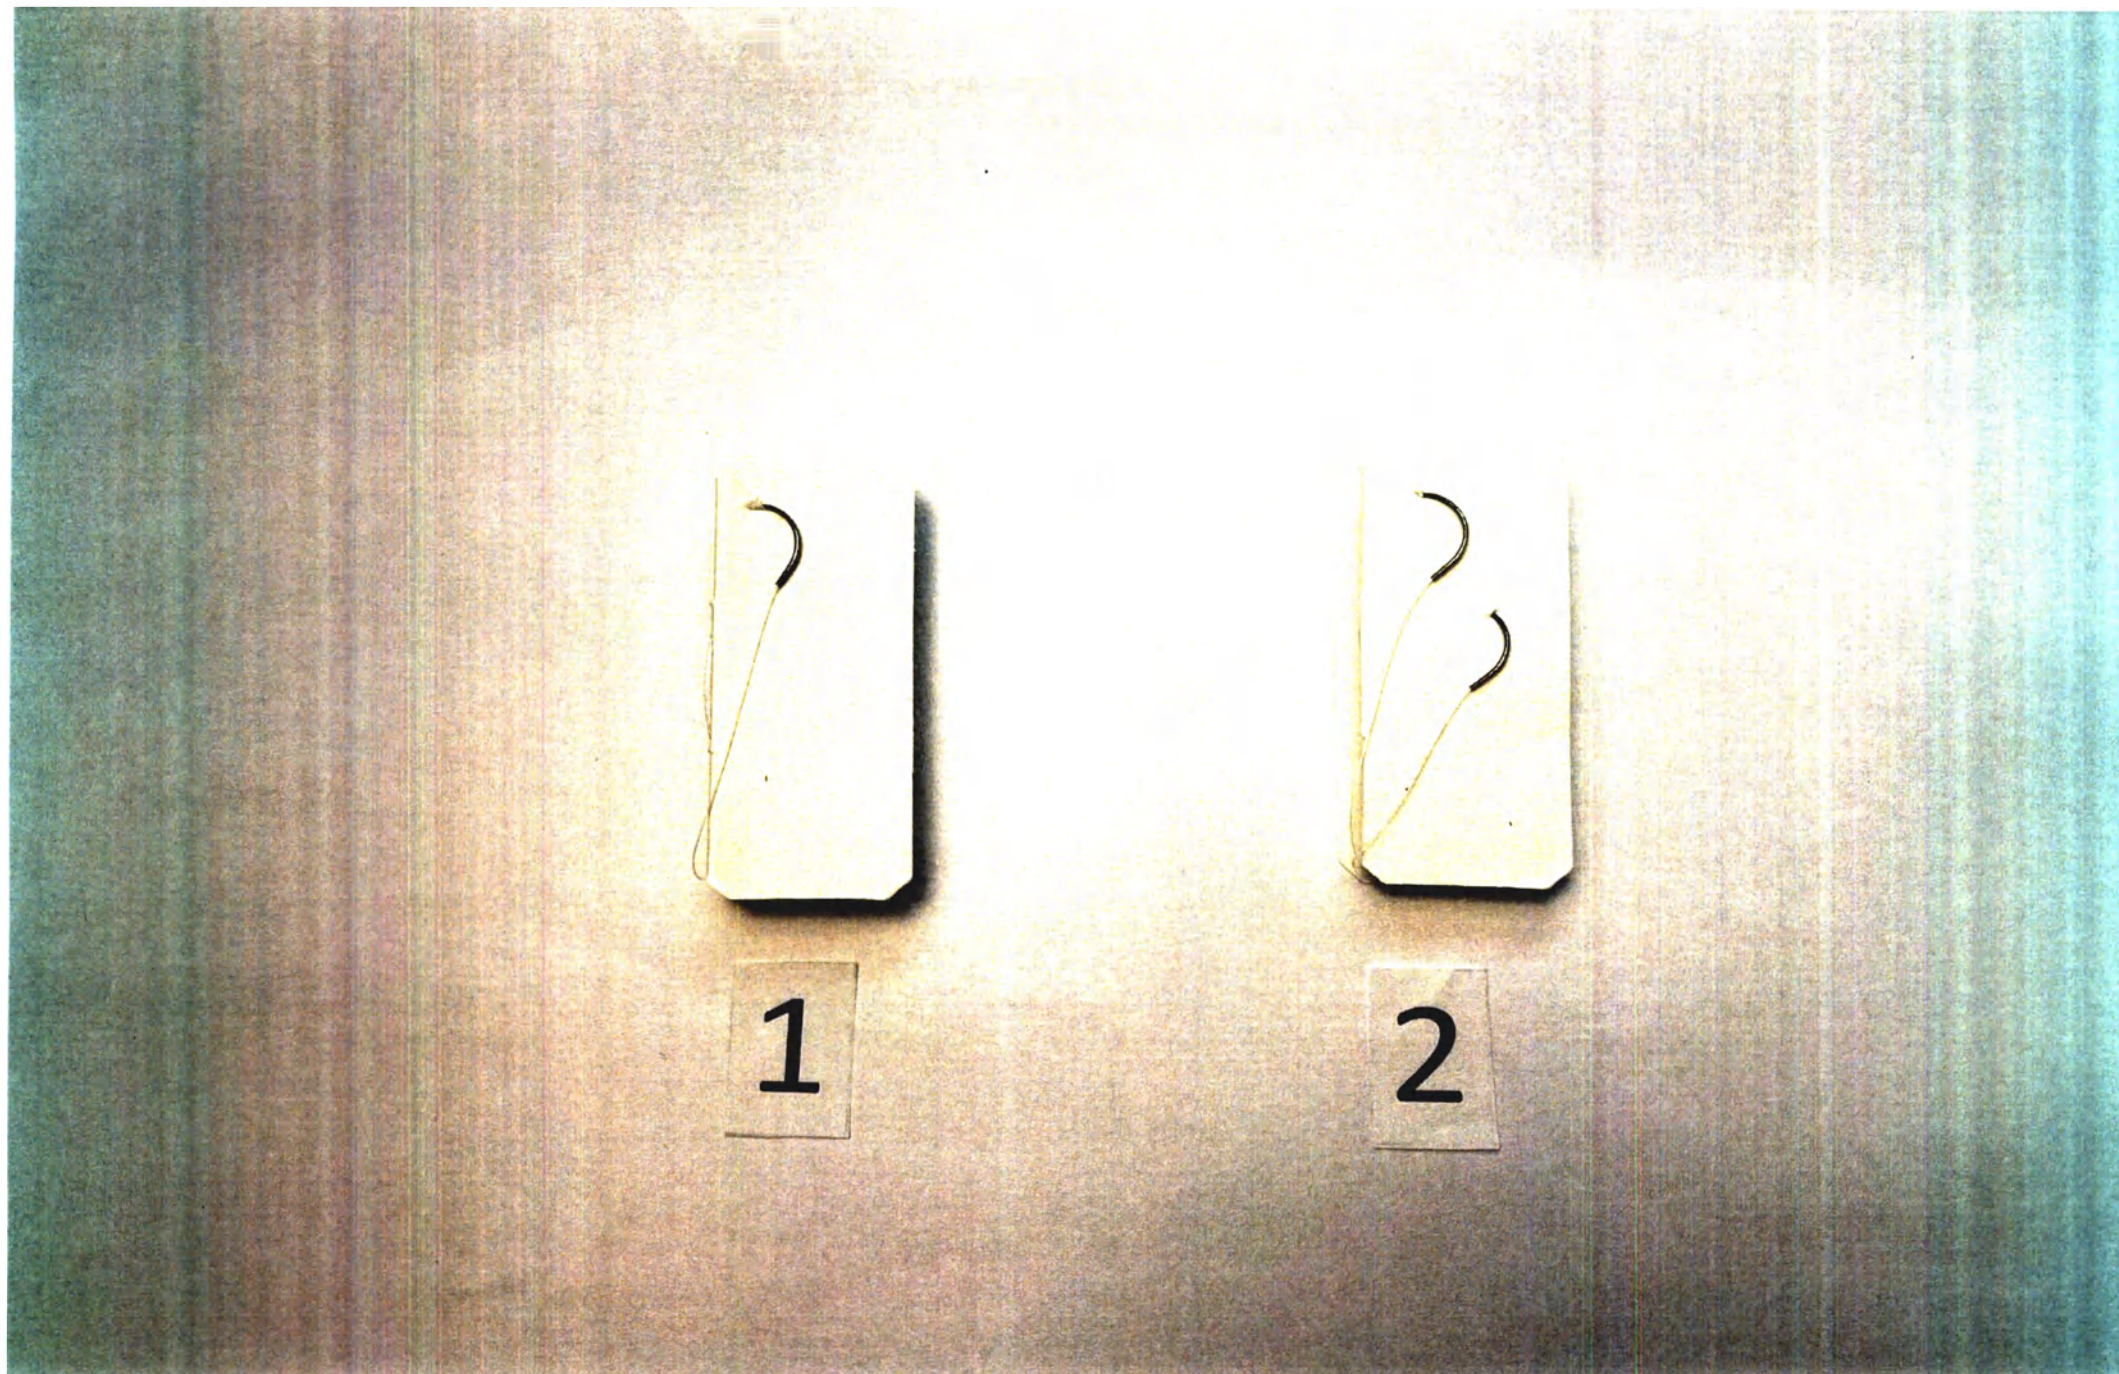


1 и 2 Мононить полиамидная неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

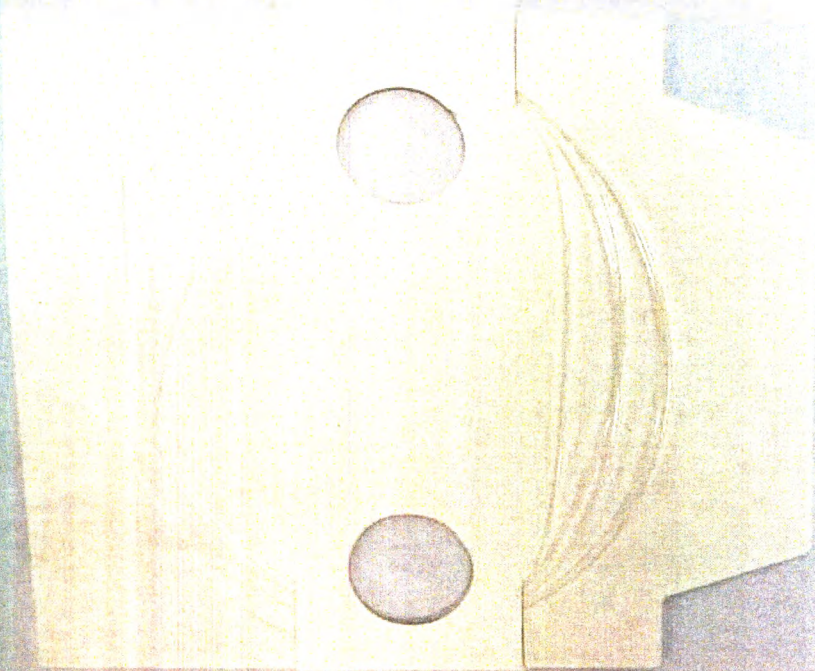

1

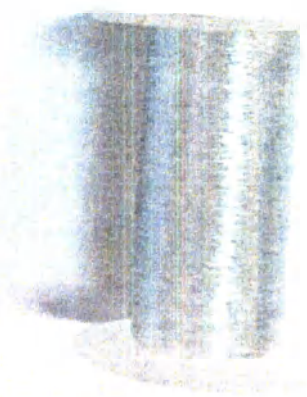

2

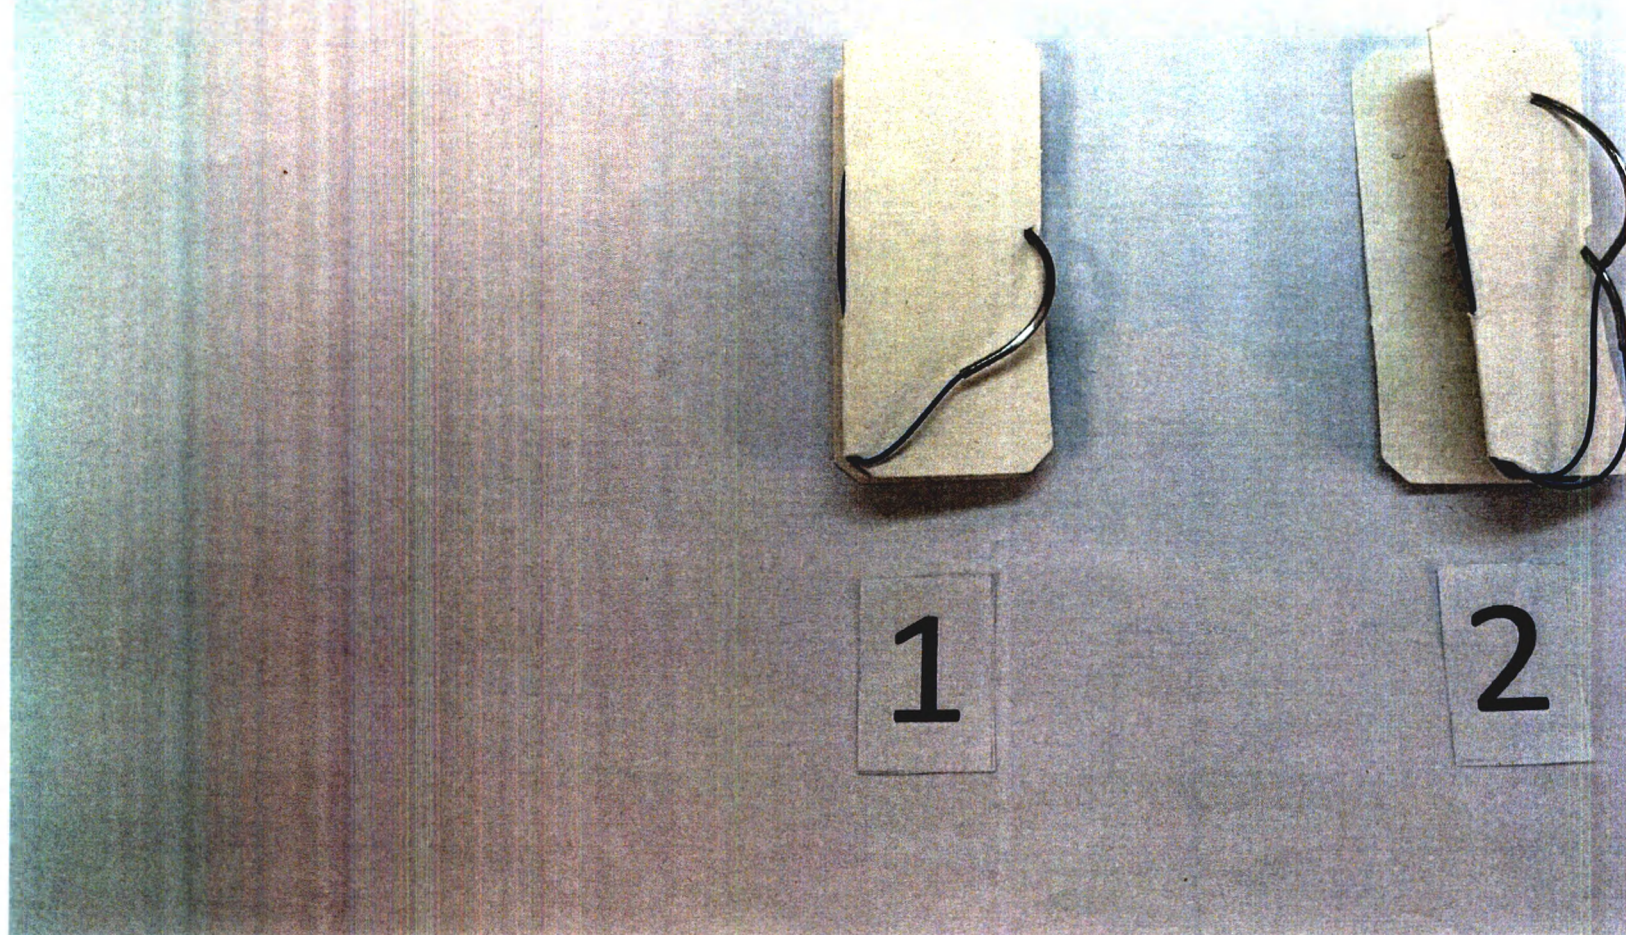


1 и 2 Мононить полиамидная окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная




1



2

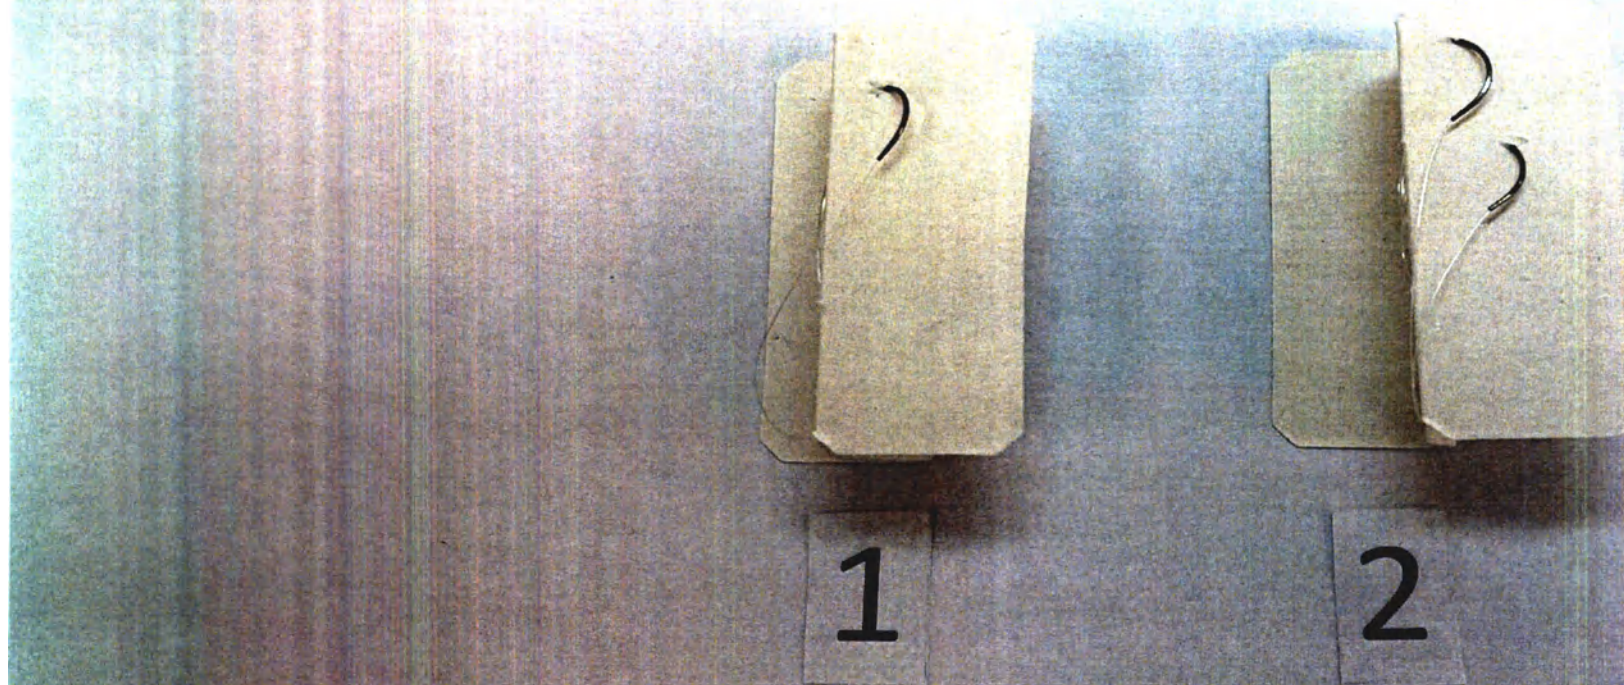


1 и 2 Мононить полипропиленовая неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

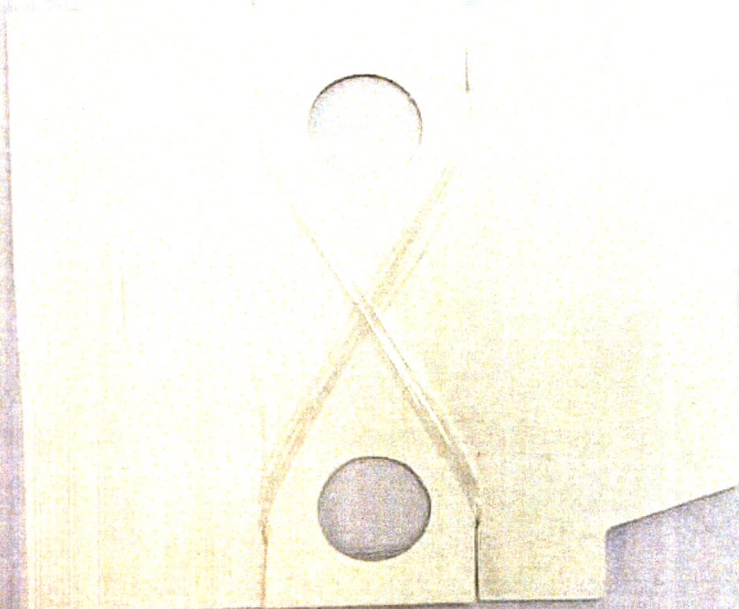

1



2

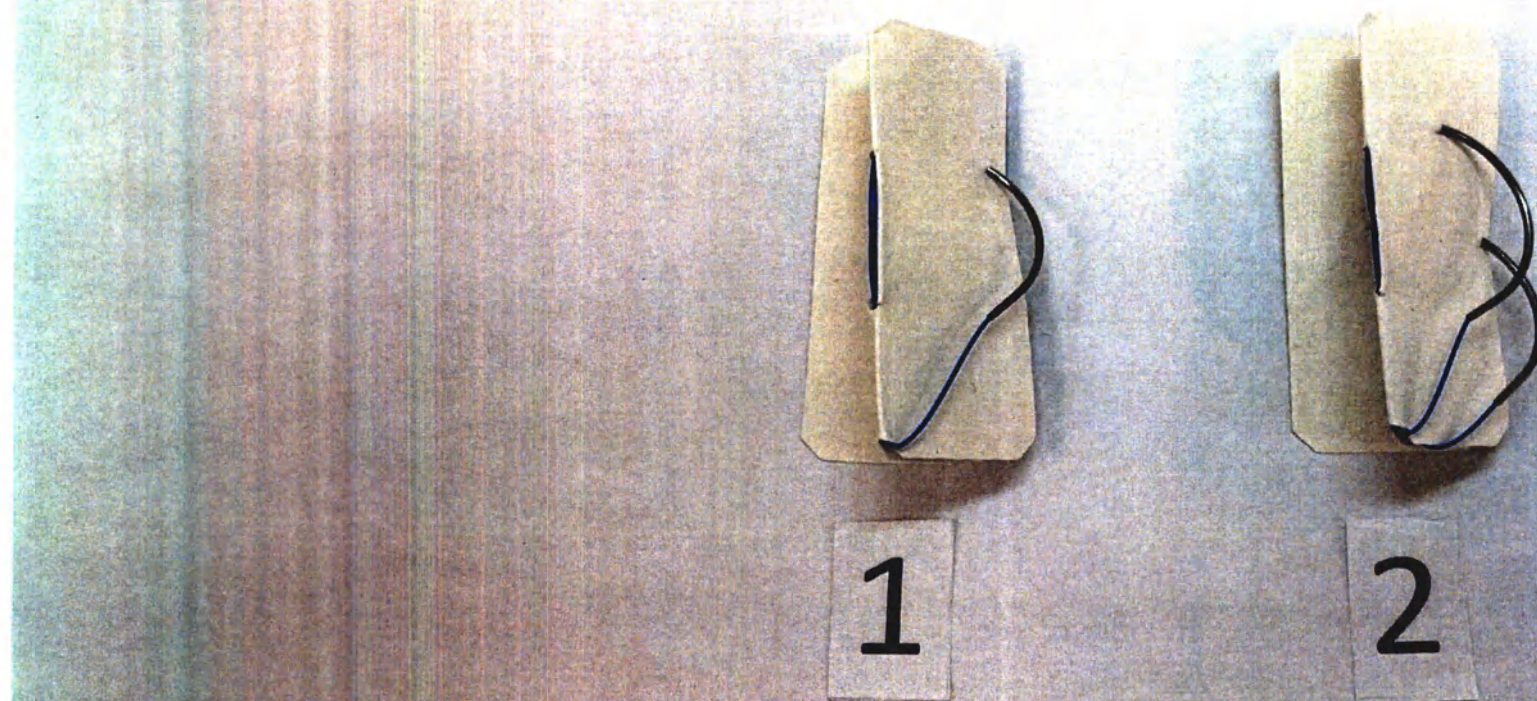


1 и 2 Мононить полипропиленовая окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная




1



2

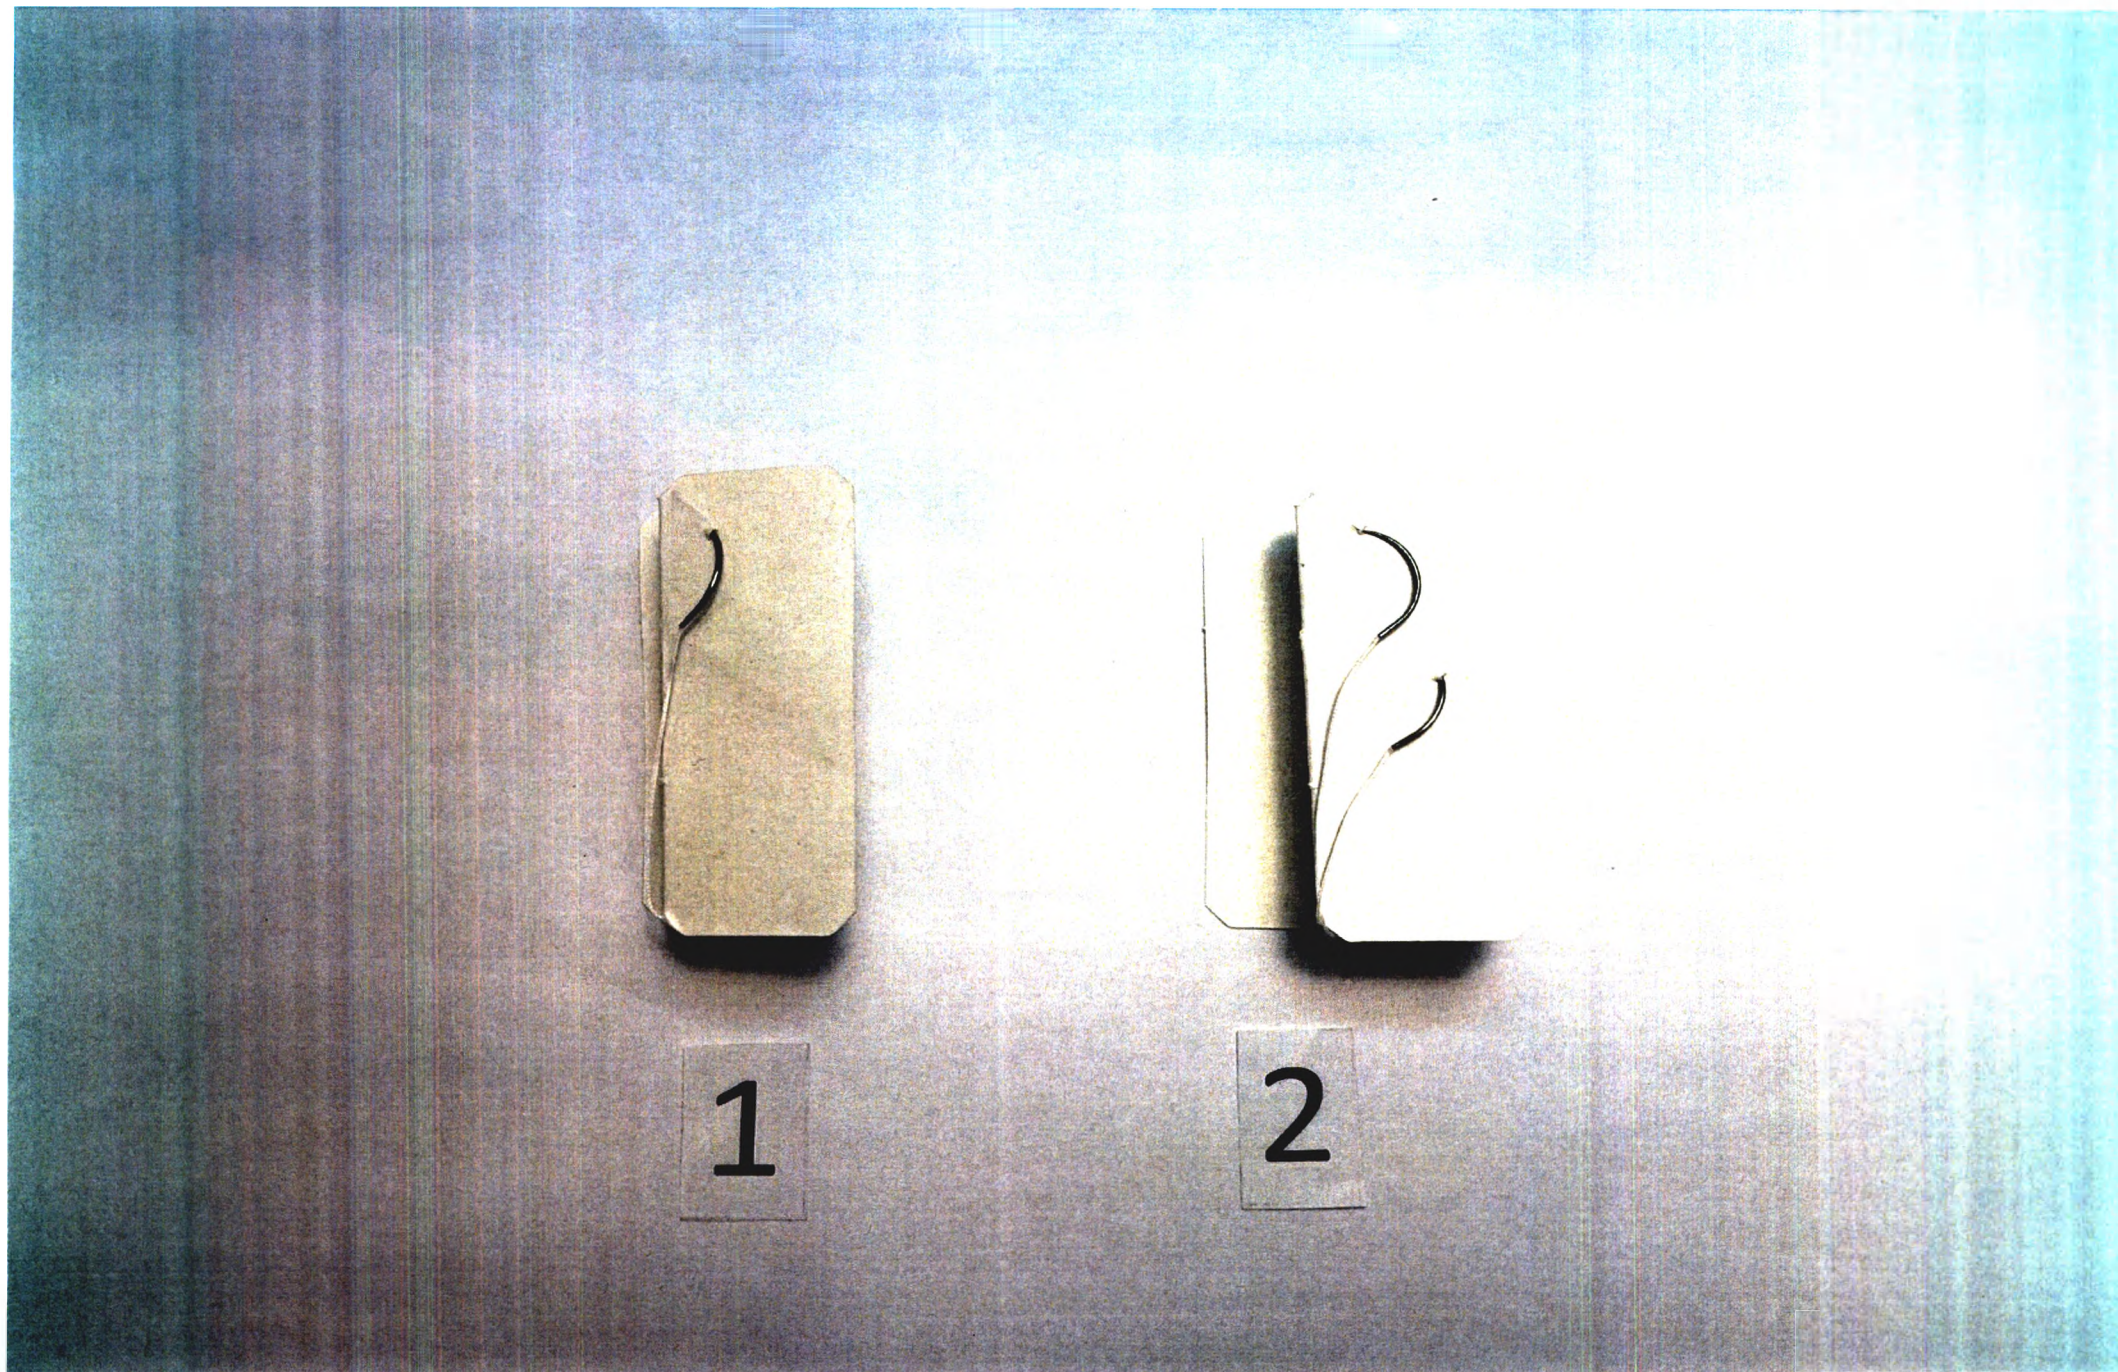

1 и 2 Нить полигликолидная плетеная неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

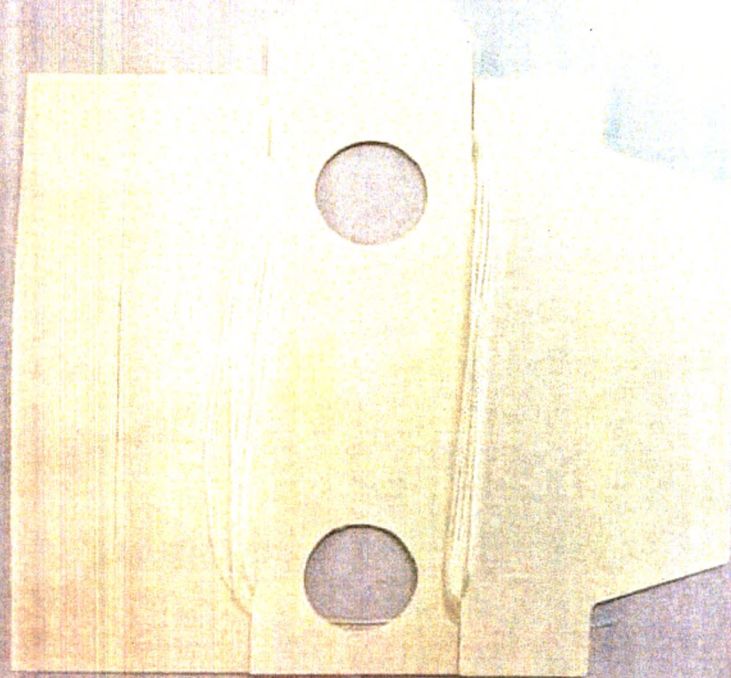


1




2




1 и 2 Нить полигликолидная плетеная окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

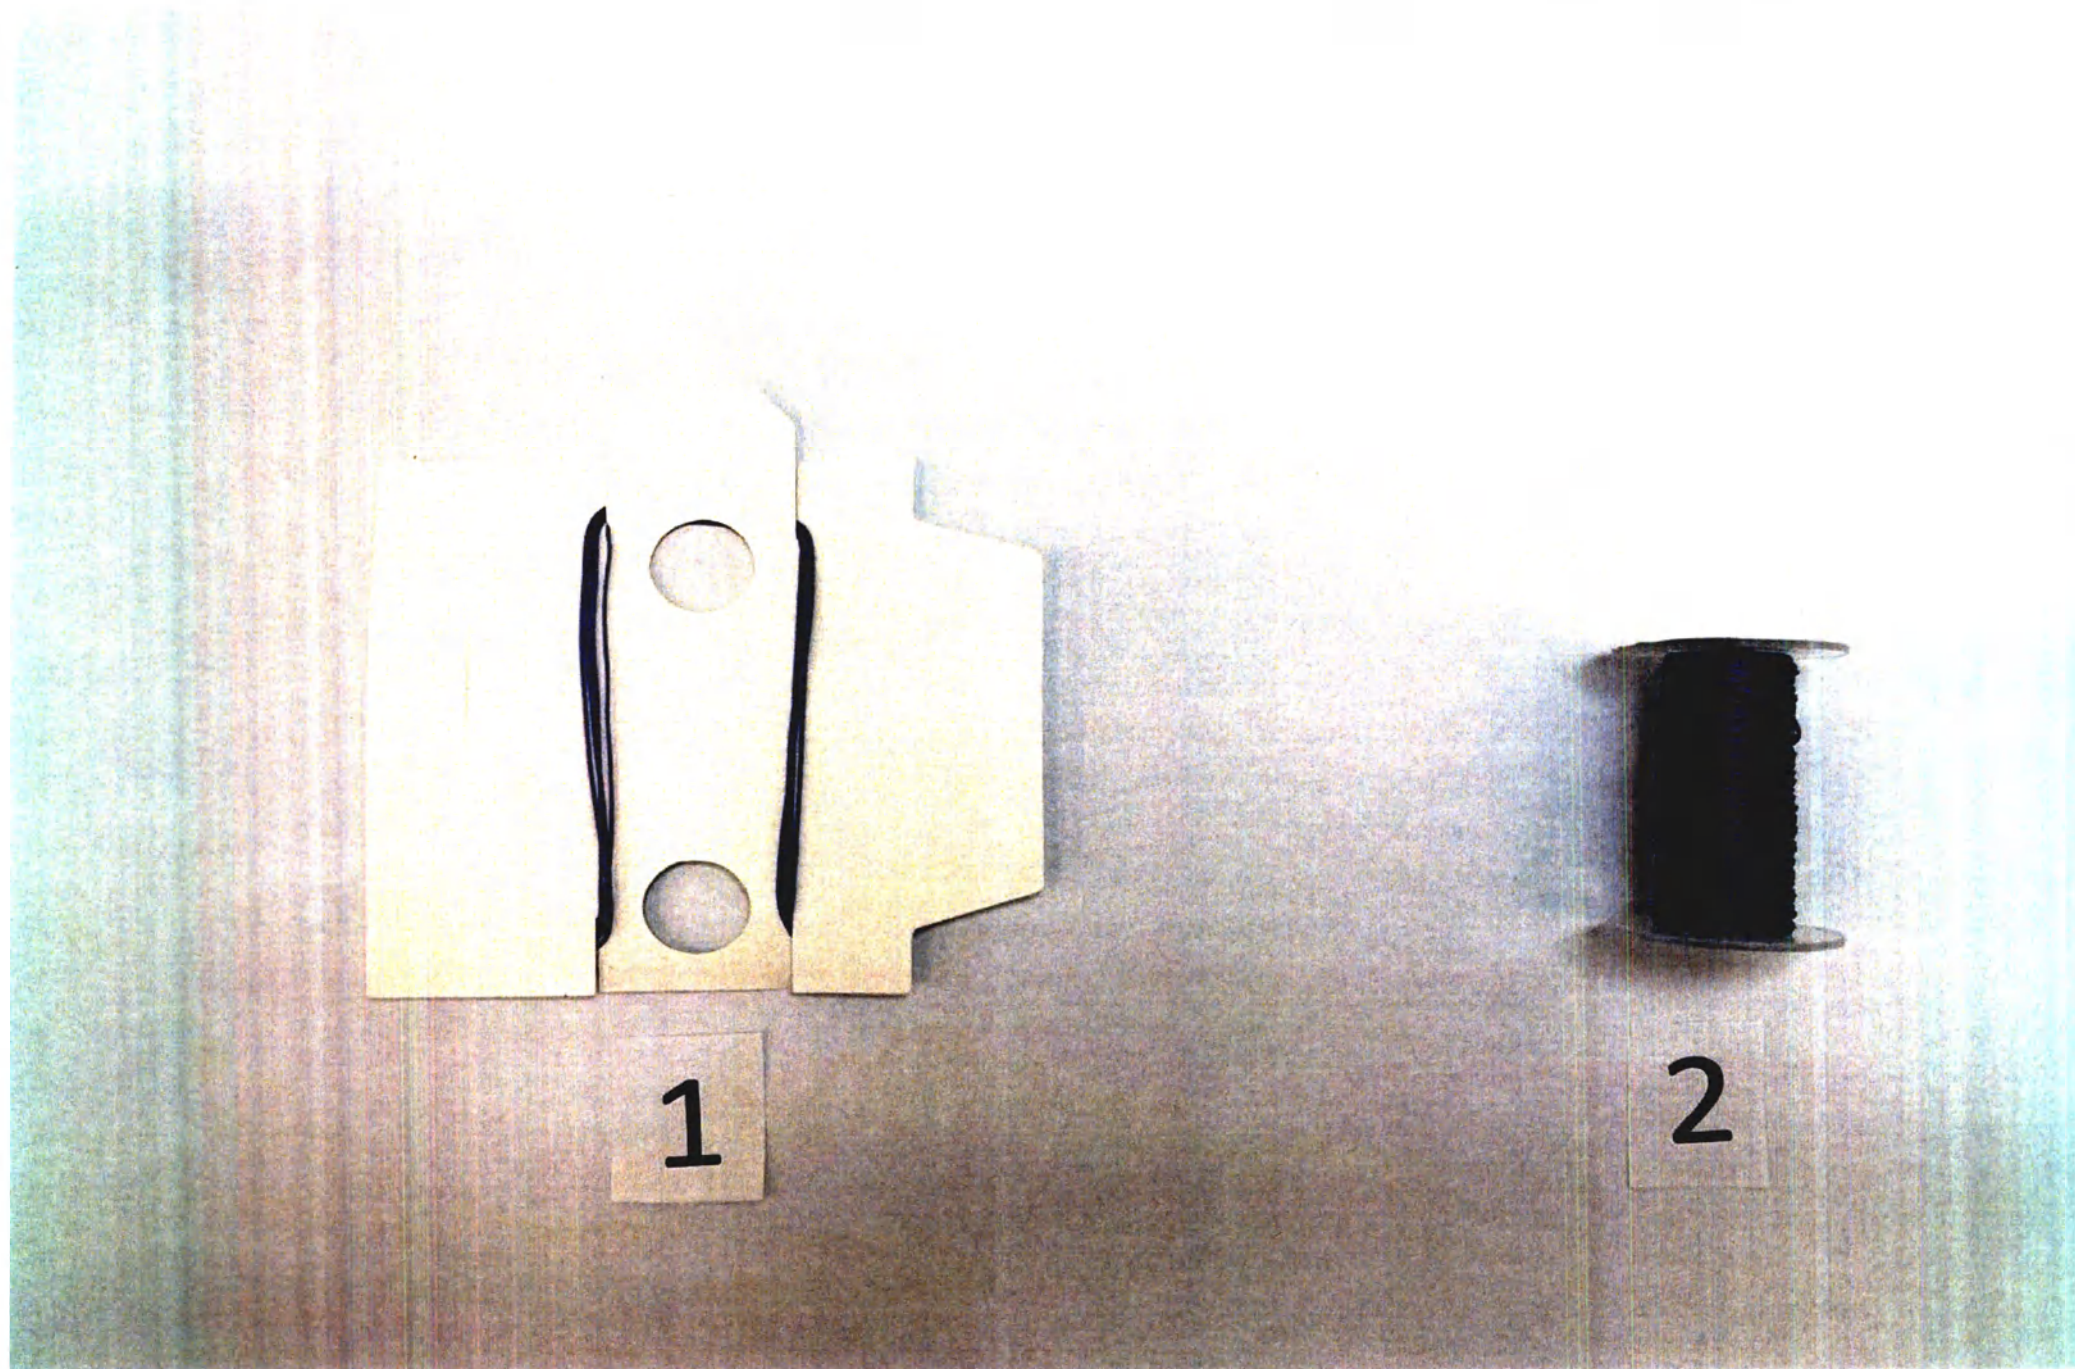

1 и 2 Нить полигликолидная плетеная окрашенная без игл «Оптикум» стерильная (1 - в отрезке, 2 - на катушке)

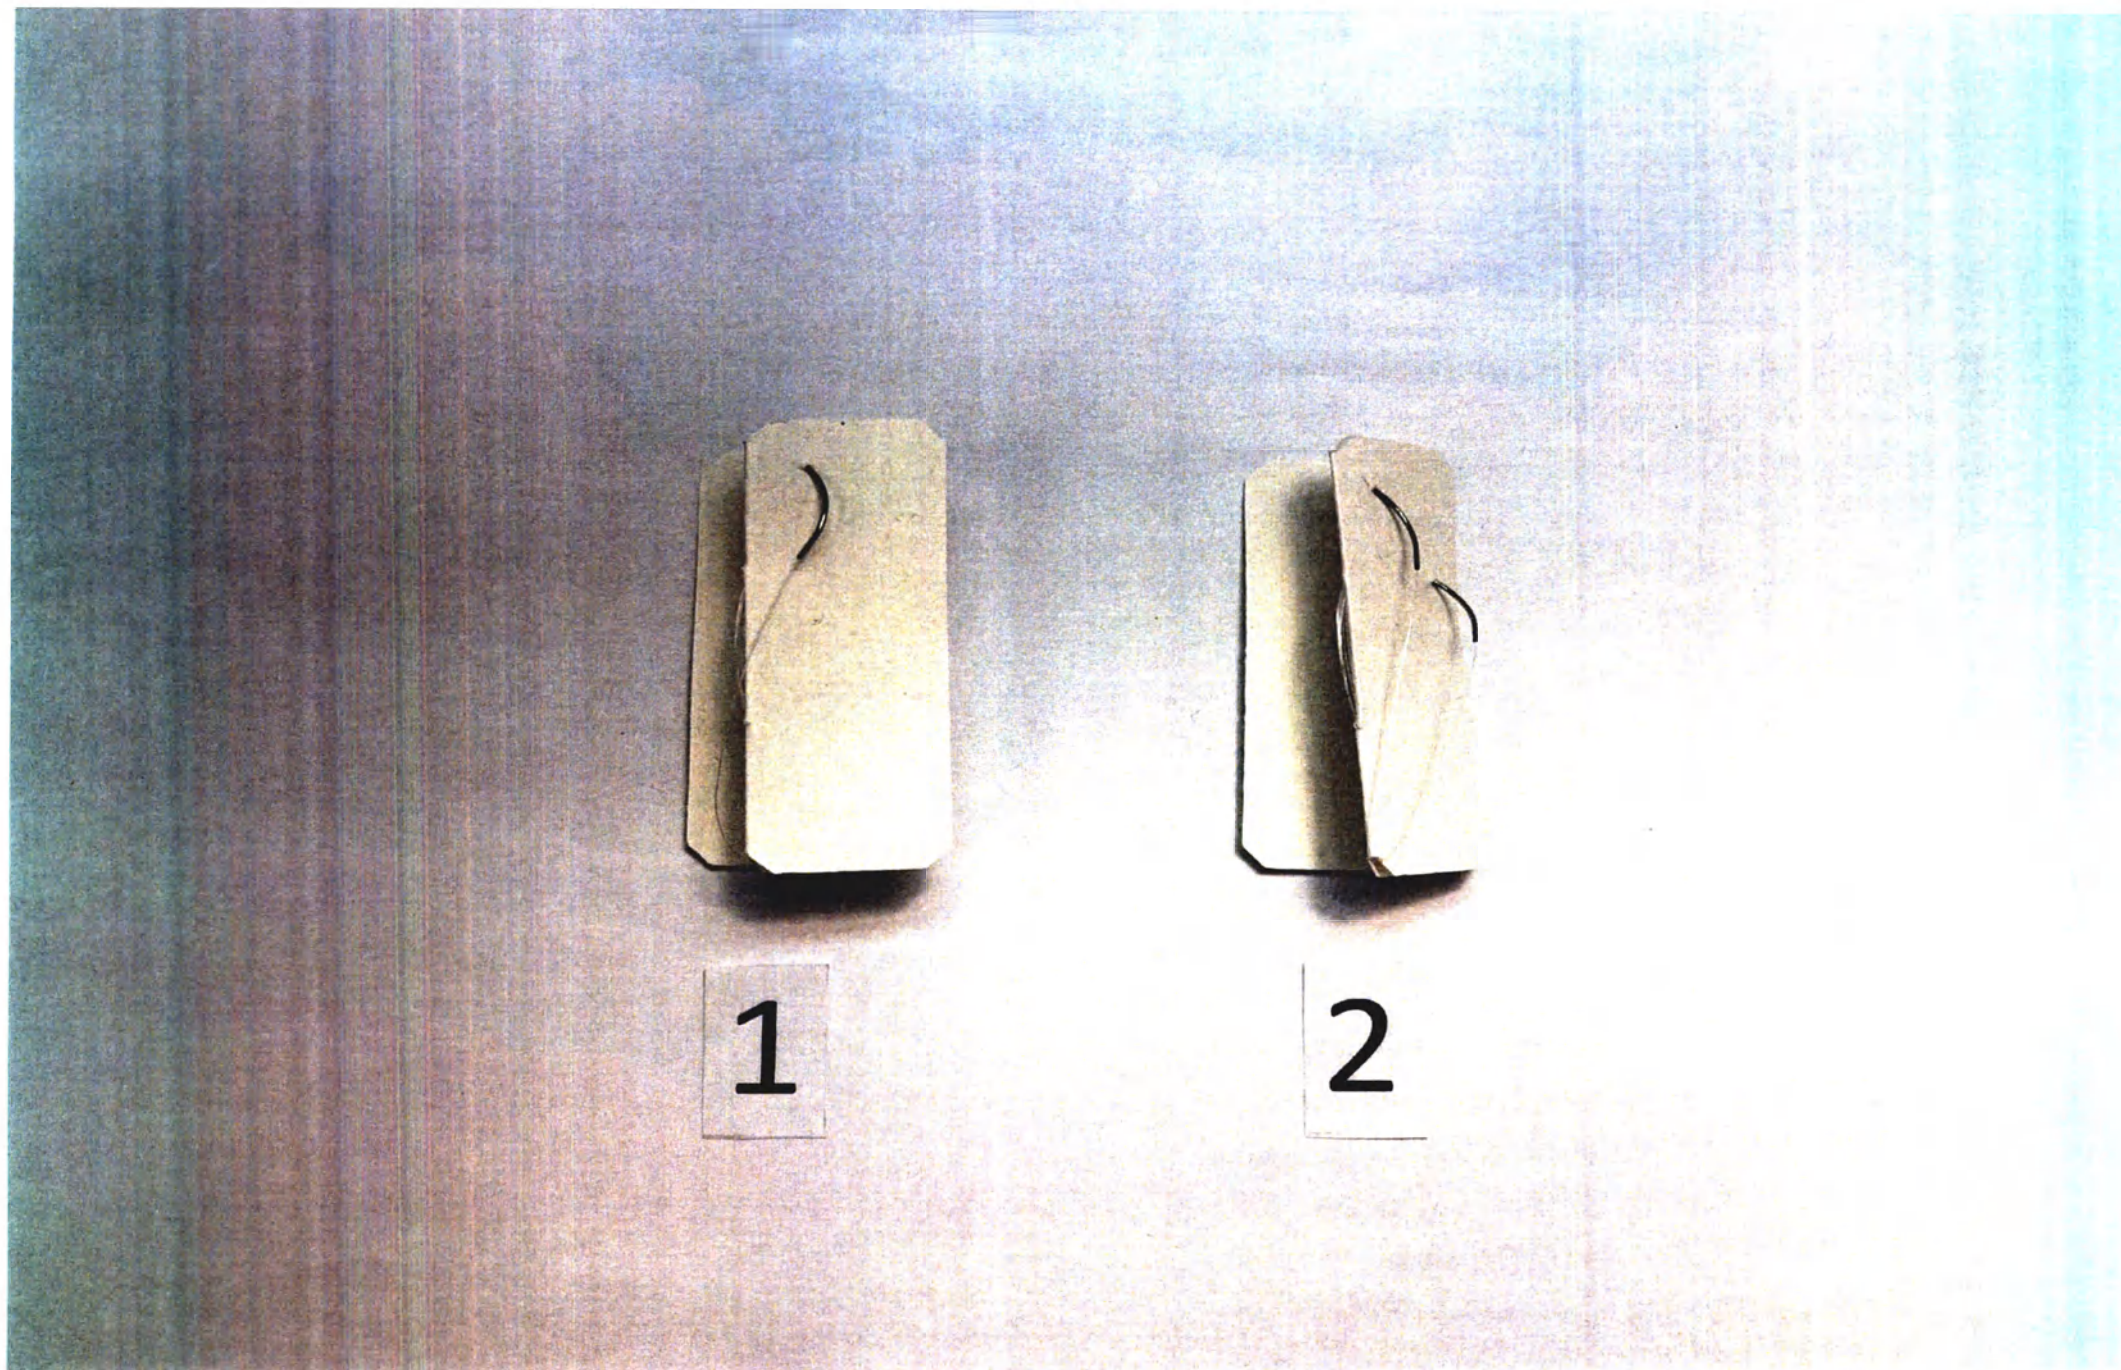


1 и 2 Мононить полидиоксаноновая неокрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

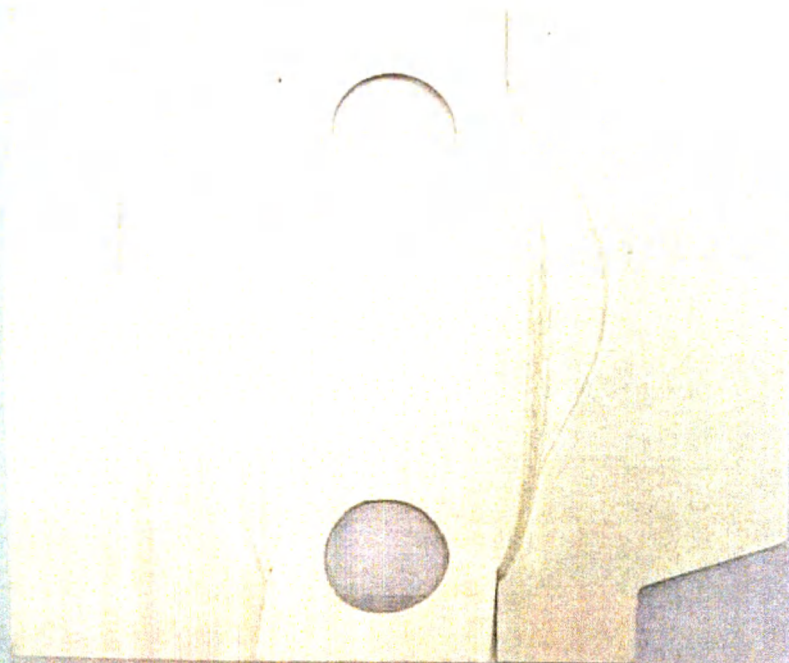

1



2

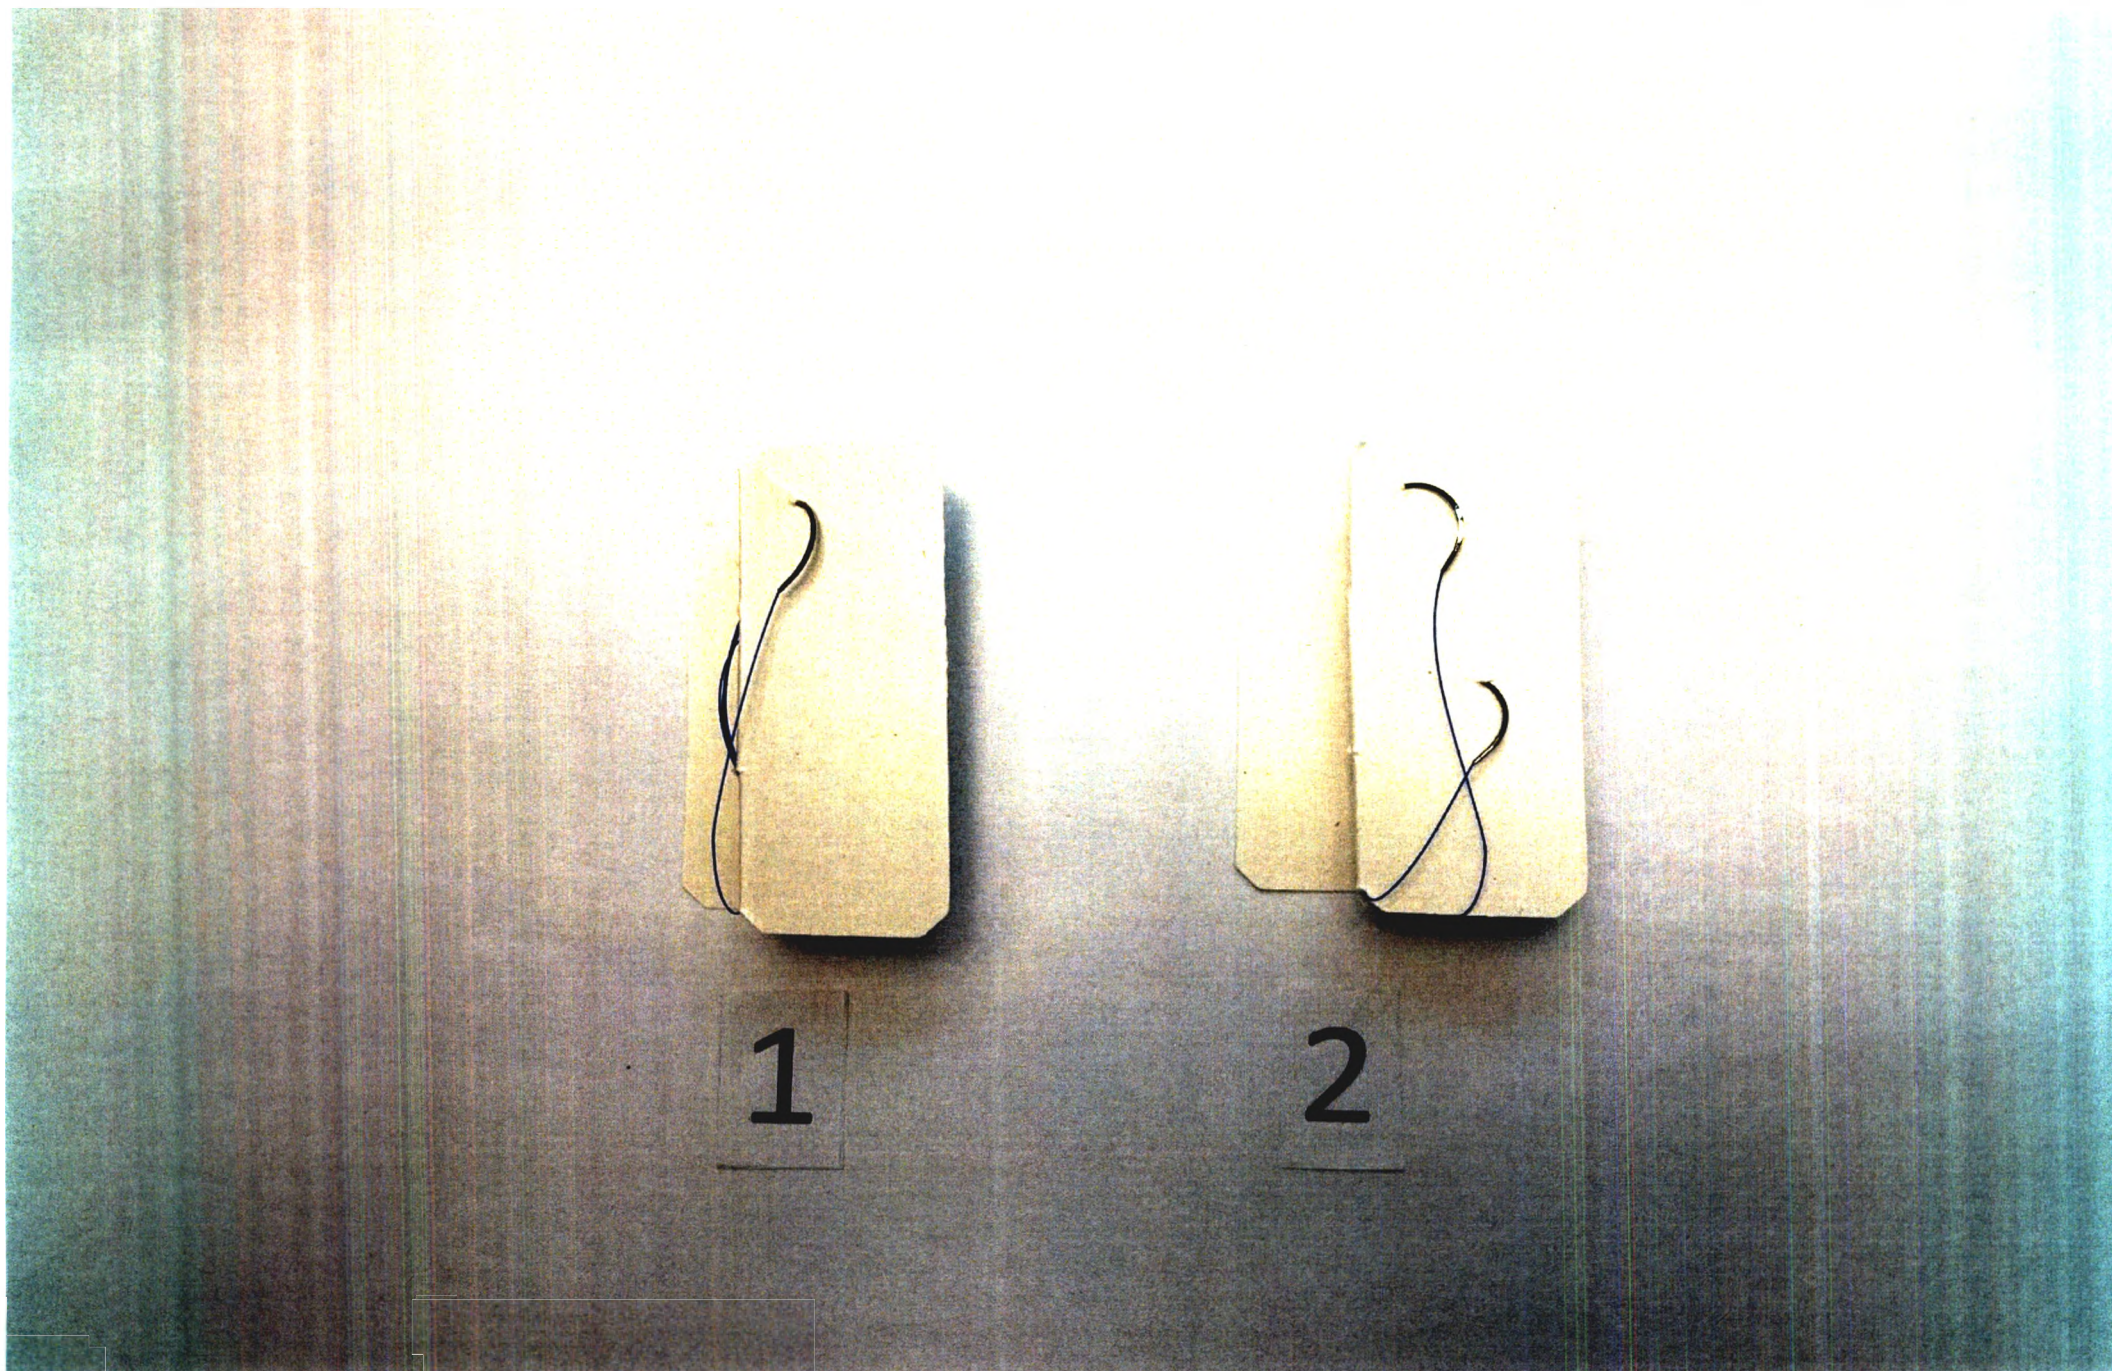

1 и 2 Мононить полидиоксаноновая окрашенная с иглами атравматическими «Оптикум» стерильная

Прошито и
пронумеровано
54 / метакрилат лист 9
гетеро

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Бойков С.Ю.





**Общество с ограниченной
ответственностью
«ОПТИКУМ»**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Оптикум»
Бойков С.Ю.



«15» апреля 2024 г.

**Макеты маркировки медицинского изделия
«Материалы хирургические шовные
«Оптикум» стерильные
по ТУ 9393-004-93420730-2008**

123007 ГОСЗДРАВ НАДЗОР
 СЕРТИФИКАТ
 123007 ГОСЗДРАВ НАДЗОР
 СЕРТИФИКАТ
 123007 ГОСЗДРАВ НАДЗОР
 СЕРТИФИКАТ

Материалы хирургические шовные "Оптикум" стерильные
 по ТУ 9393-004-93420730-2008
 Вариант исполнения: Нить полигликолидная плетеная окрашенная
 с иглами атравматическими "Оптикум" стерильная

USP 1 MP 4
 рассасывающаяся
 цвет: фиолетовая
 длина нити: 75 см

1 x HR-35

ПАРТИЯ № ПГАСПЛ.4.24.1
 РУ № ФСР 2009/05648 от 20.09.2021 г.
 ТУ 9393-004-93420730-2008

04.2024
 03.2027

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной потребительской упаковки медицинского изделия

123007 Г. МОСКВА ВН ТЕРИТ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
 ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ ПР-ОБД. 2-й
 КОРОШЕВСКИЙ Д.К. 2 ЭТАЖ 5, КОМ. 28

Материалы хирургические шовные "Оптикум" стерильные
 по ТУ 9393-004-93420730-2008
 Вариант исполнения: Мононить полидиоксаноновая окрашенная
 с иглами травматическими "Оптикум" стерильная

USP 3/0 MP 2
 рассасывающаяся
 цвет: фиолетовая
 длина нити: 100 см

1 x HR-25

ПАРТИЯ № ПДОс.2.24.1
 РУ № ФСР 2009/05648 от 20.09.2021 г.
 ТУ 9393-004-93420730-2008

04.2024
 03.2027

НЕТОКСИЧНО

Макет маркировки индивидуальной потребительской упаковки медицинского изделия

123007 ГИОСОВА ВНИТЕРЬ МОНЕЦИТАЛИНАМ
 ОБЪЕКТ КОРОШЕСОМ ПРОЕДИ 2.4
 КОРОШЕСОМ ДВУХ ЭТАЖ 3 КОМ 28

ОПТИКУМ
 Материалы хирургические шовные "Оптикум" стерильные
 по ТУ 9393-004-93420730-2008
 Вариант исполнения: Мононить полидиоксаноновая неокрашенная
 с иглами атравматическими "Оптикум" стерильная


USP 2/0 MP 3
 рассасывающаяся 2 x HS-20
 длина нити: 75см

ПАРТИЯ № ПДОс.3.24.1
 РУ № ФСР 2009/05648 от 20.09.2021 г.
 ТУ 9393-004-93420730-2008

04.2024
 03.2027

НЕТОКСИЧНО

Макет маркировки индивидуальной потребительской упаковки медицинского изделия

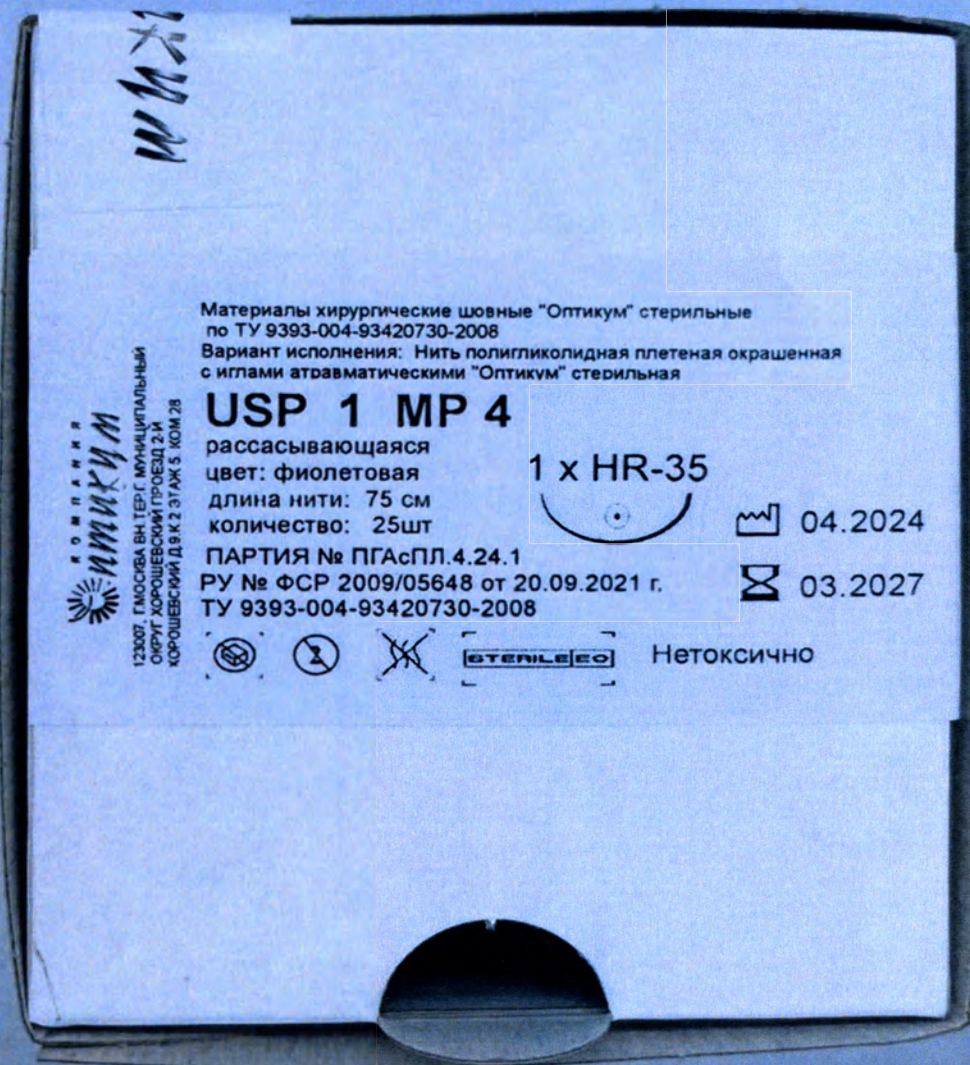

Макет маркировки групповой упаковки медицинского изделия

0222

компания
оптик
123007, Г. МОСКВА, ВН. ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, ПРОЕЗД 2-й
ХОРОШЕВСКИЙ Д. 9 К. 2 ЭТАЖ 5 КОМ. 28

Материалы хирургические шовные "Оптикум" стерильные
по ТУ 9393-004-93420730-2008
Вариант исполнения: Мононить полидиоксаноновая окрашенная
с иглами атравматическими "Оптикум" стерильная

USP 3/0 MP 2

рассасывающаяся
цвет: фиолетовая
длина нити: 100 см
количество: 25 шт

1 x HR-25



 04.2024

 03.2027

ПАРТИЯ № ПДОс.2.24.1

РУ № ФСР 2009/05648 от 20.09.2021 г.

ТУ 9393-004-93420730-2008



STERILE EO

Нетоксично

компания
оптикум
123007, Г. МОСКВА ВН ТЕРГ. ИМЦИЦИТАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ ПР. ОЗЕД 2-й
ХОРОШЕВСКИЙ Д 9 К 2 ЭТАЖ 5 КОМ. 28

Материалы хирургические шовные "Оптикум" стерильные
по ТУ 9393-004-93420730-2008
Вариант исполнения: Мононить полидиоксаноновая неокрашенная
с иглами атравматическими "Оптикум" стерильная

USP 2/0 MP 3 2 x HS-20

рассасывающаяся

длина нити: 75см

количество: 25шт

ПАРТИЯ № ПДОс.3.24.1


РУ №ФСР 2009/05648 от 20.09.2021 г.

ТУ 9393-004-93420730-2008



04.2024

03.2027



Нетоксично

Макет маркировки групповой упаковки медицинского изделия

Система менеджмента качества
сертифицирована в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ ISO 13485



Общество с ограниченной
ответственностью «Оптикум»
e-mail: main@optikum.biz
www.optikum.biz

Боковая сторона групповой упаковки медицинского изделия


 ООО «Оптикум» (Россия)

142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.17.

 ООО «Оптикум» (Россия)

141195, Московская область, г.о. Фрязино, г.Фрязино, ул. Горького, д. 10а, стр.3 часть здания 1(чз1)
комнаты: №1 -25

Юридический адрес: 123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский,
2-й Хорошёвский проезд, д.9 к.2, этаж 5, ком.28

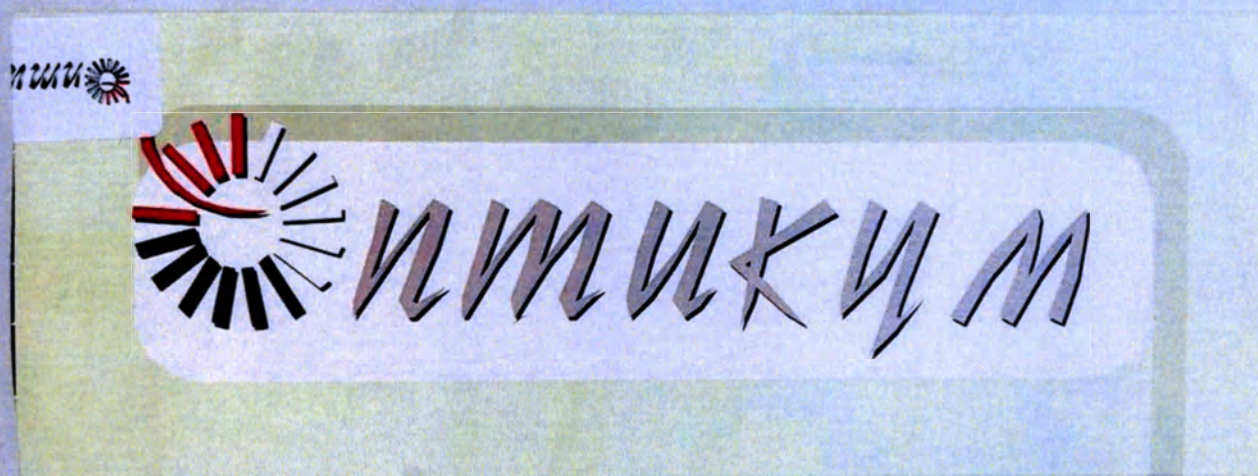

Групповая упаковка медицинского изделия (вид сверху)

ООО «Оптикум»

Адрес: 123007, Г. МОСКВА,
ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ,
ПРОЕЗД 2-Й ХОРОШЕВСКИЙ, Д. 9 К. 2, ЭТАЖ 5, КОМ. 28
Материалы хирургические шовные «Оптикум» стерильные по
ТУ 9393-004-93420730-2008

Вариант исполнения: Мононить полидиоксаноновая неокрашенная с
иглами в травматическом «Оптикум» стерильная

Рассасывающаяся

Условный номер; метрический размер: USP 2/0 MP 3

Длина нити- 75 см

Игла: 2 X HS-20 режущая

Количество единиц продукции: 900 шт. (36 групповых коробок по 25 шт.)

Партия № ПДОс. 3.24.1

Дата выпуска: 04.2024

Срок годности: 03.2027

Условие транспортирования: по условию хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Условие хранения: по условию хранения 1 «Д» по ГОСТ 15150-69



ТУ 9393-004-93420730-2008

Маркировка транспортной упаковки (пример)

ЖМ

ЖМ
125017, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, ПРОЕЗД 2-й
ХОРОШЕВСКИЙ, Д. 9 К. 2, ЭТАЖ 5, КОМ. 28

Материалы хирургические шовные "Оптикум"
стерильные по ТУ 9393-004-93420730-2008
Вариант исполнения: Нить полиэфирная
плетеная окрашенная с иглами
атравматическими "Оптикум" стерильная

USP 0 MP 3,5

нерассасывающаяся

цвет: зеленая

длина нити: 75 см

количество: 25 шт

2 x HS -20



04.2024
03.2027

ПАРТИЯ № ПЭТОСП.3,5.24.1

РУ № ФСР 2009/05648 от 20.09.2021 г.
ТУ 9393-004-93420730-2008



STERILE R

НЕТОКСИЧНО

Макет маркировки групповой упаковки медицинского изделия

Материалы хирургические шовные "Оптикум"
стерильные по ТУ 9393-004-93420730-2008
Вариант исполнения: Нить полиэфирная
плетеная окрашенная с иглами
атравматическими "Оптикум" стерильная

USP 0 MP 3,5

нерассасывающаяся

цвет: зеленая

длина нити: 75 см

2 x HS -20

04.2024

03.2027

ПАРТИЯ № ПЗТФП.3.5.24.1

ПУ № ФСР 2009/05648 от 20.09.2021 г.

ТУ 9393-004-93420730-2008



STERILE

НЕТОКСИЧНО

ОПТИКУМ
ОАО "ОПТИКУМ"
125080, МОСКВА, ВН ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОЕЗД 2-й
КОРПУС 5, Д. 9 К. 2, ЭТАЖ 5, КОМ. 28

Макет маркировки индивидуальной потребительской упаковки медицинского изделия

Прошито и
пронумеровано
13 / тринац лист ов
4071

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Бойков С.Ю.

