

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Фишер энд Пэйкел Хелскэр»

А.А.Филиппов

2024



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Канюля назальная Optiflow™ Junior 2 с принадлежностями

Fisher&Paykel Healthcare Ltd. (Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лтд.),
Новая Зеландия

Рисунок 1. Внешний вид Канюли назальной Optiflow™ Junior 2 размера XS



Рисунок 2. Внешний вид назальных зубцов Канюли назальной Optiflow™ Junior 2 размера XS

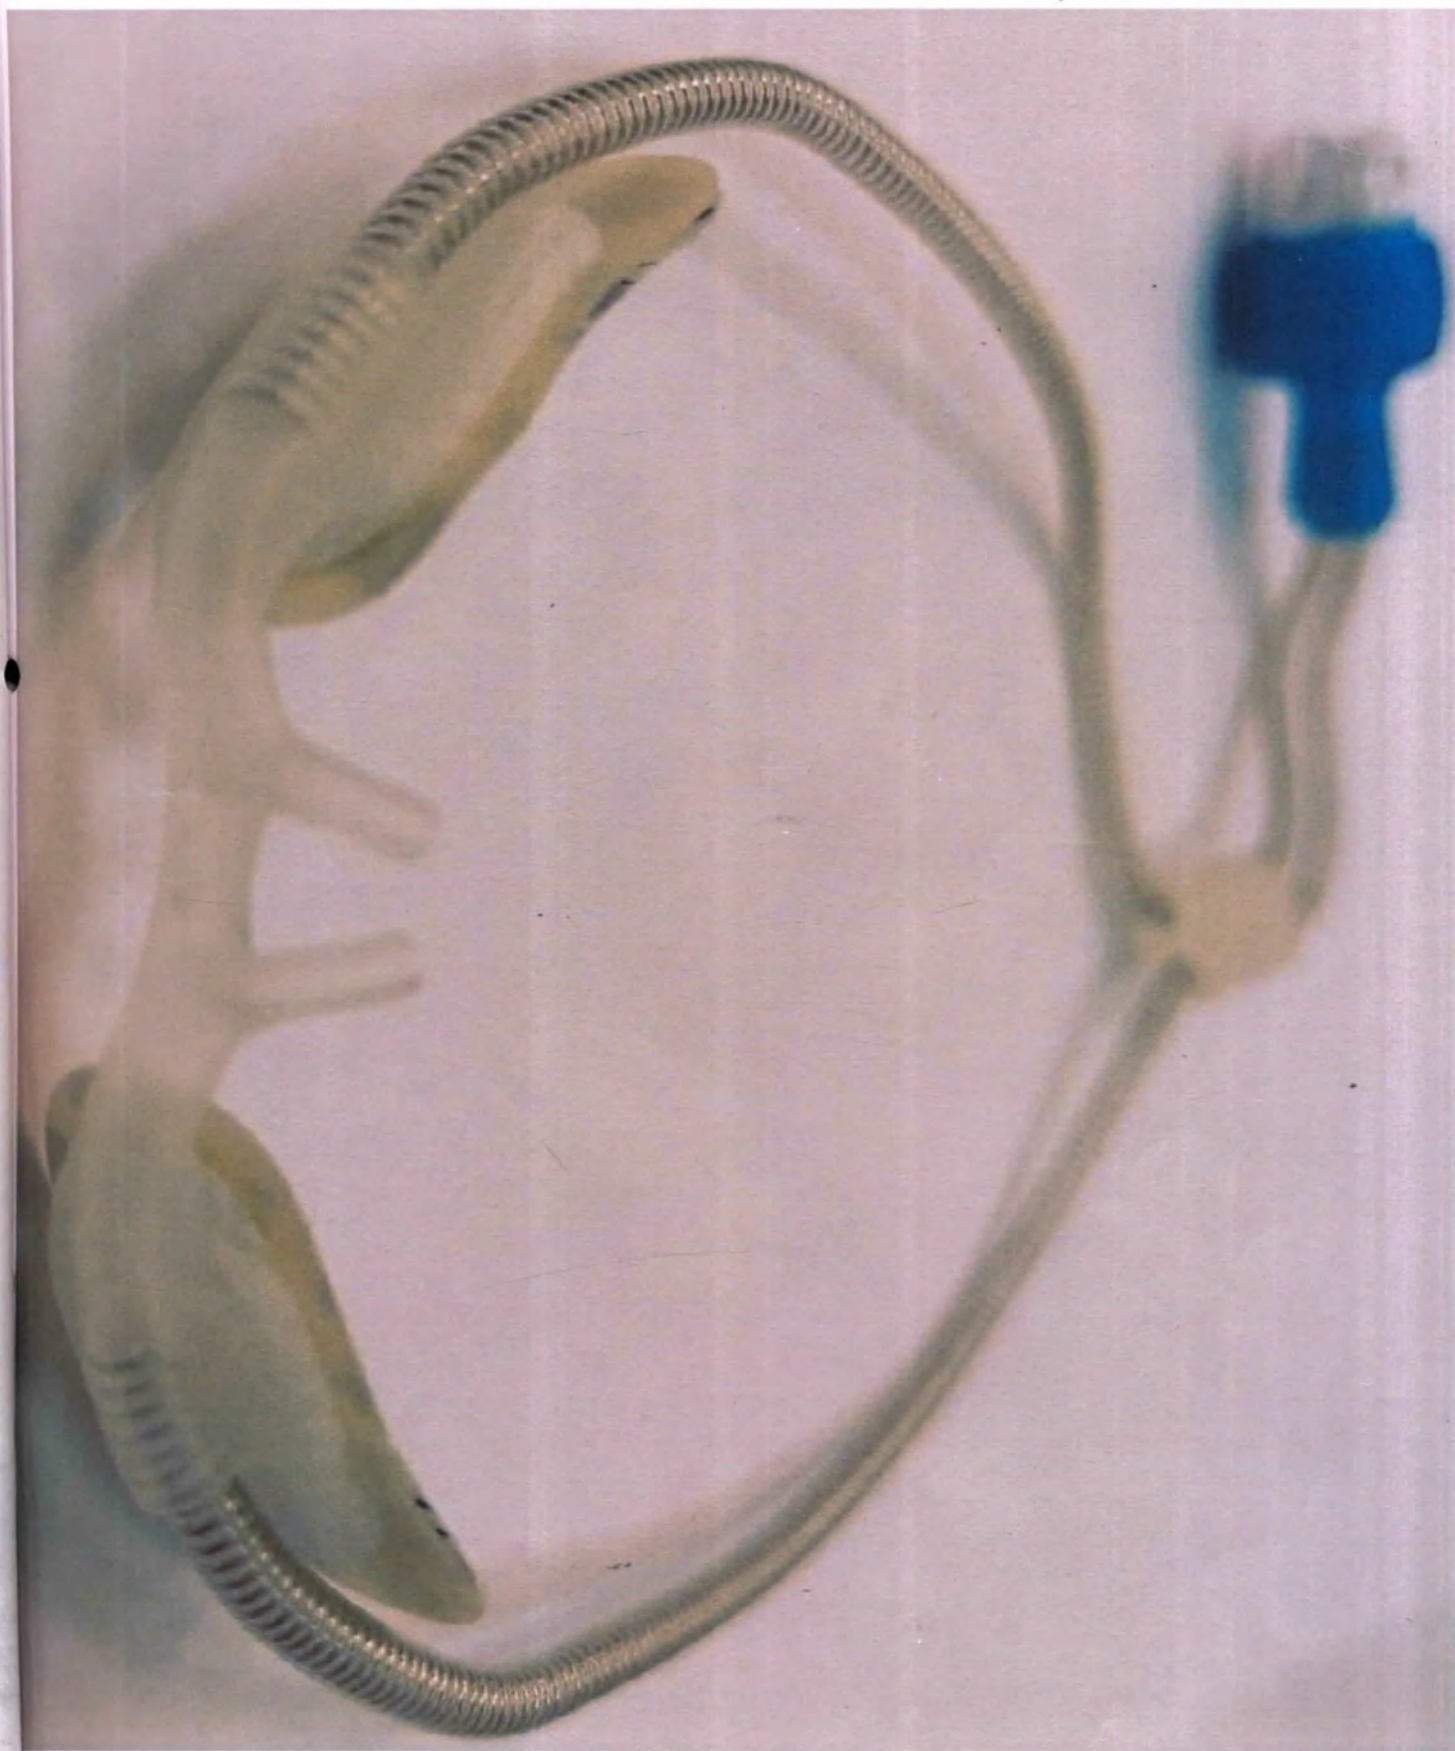


Рисунок 3. Внешний вид коннектора Канюли назальной Optiflow™ Junior 2 размера XS

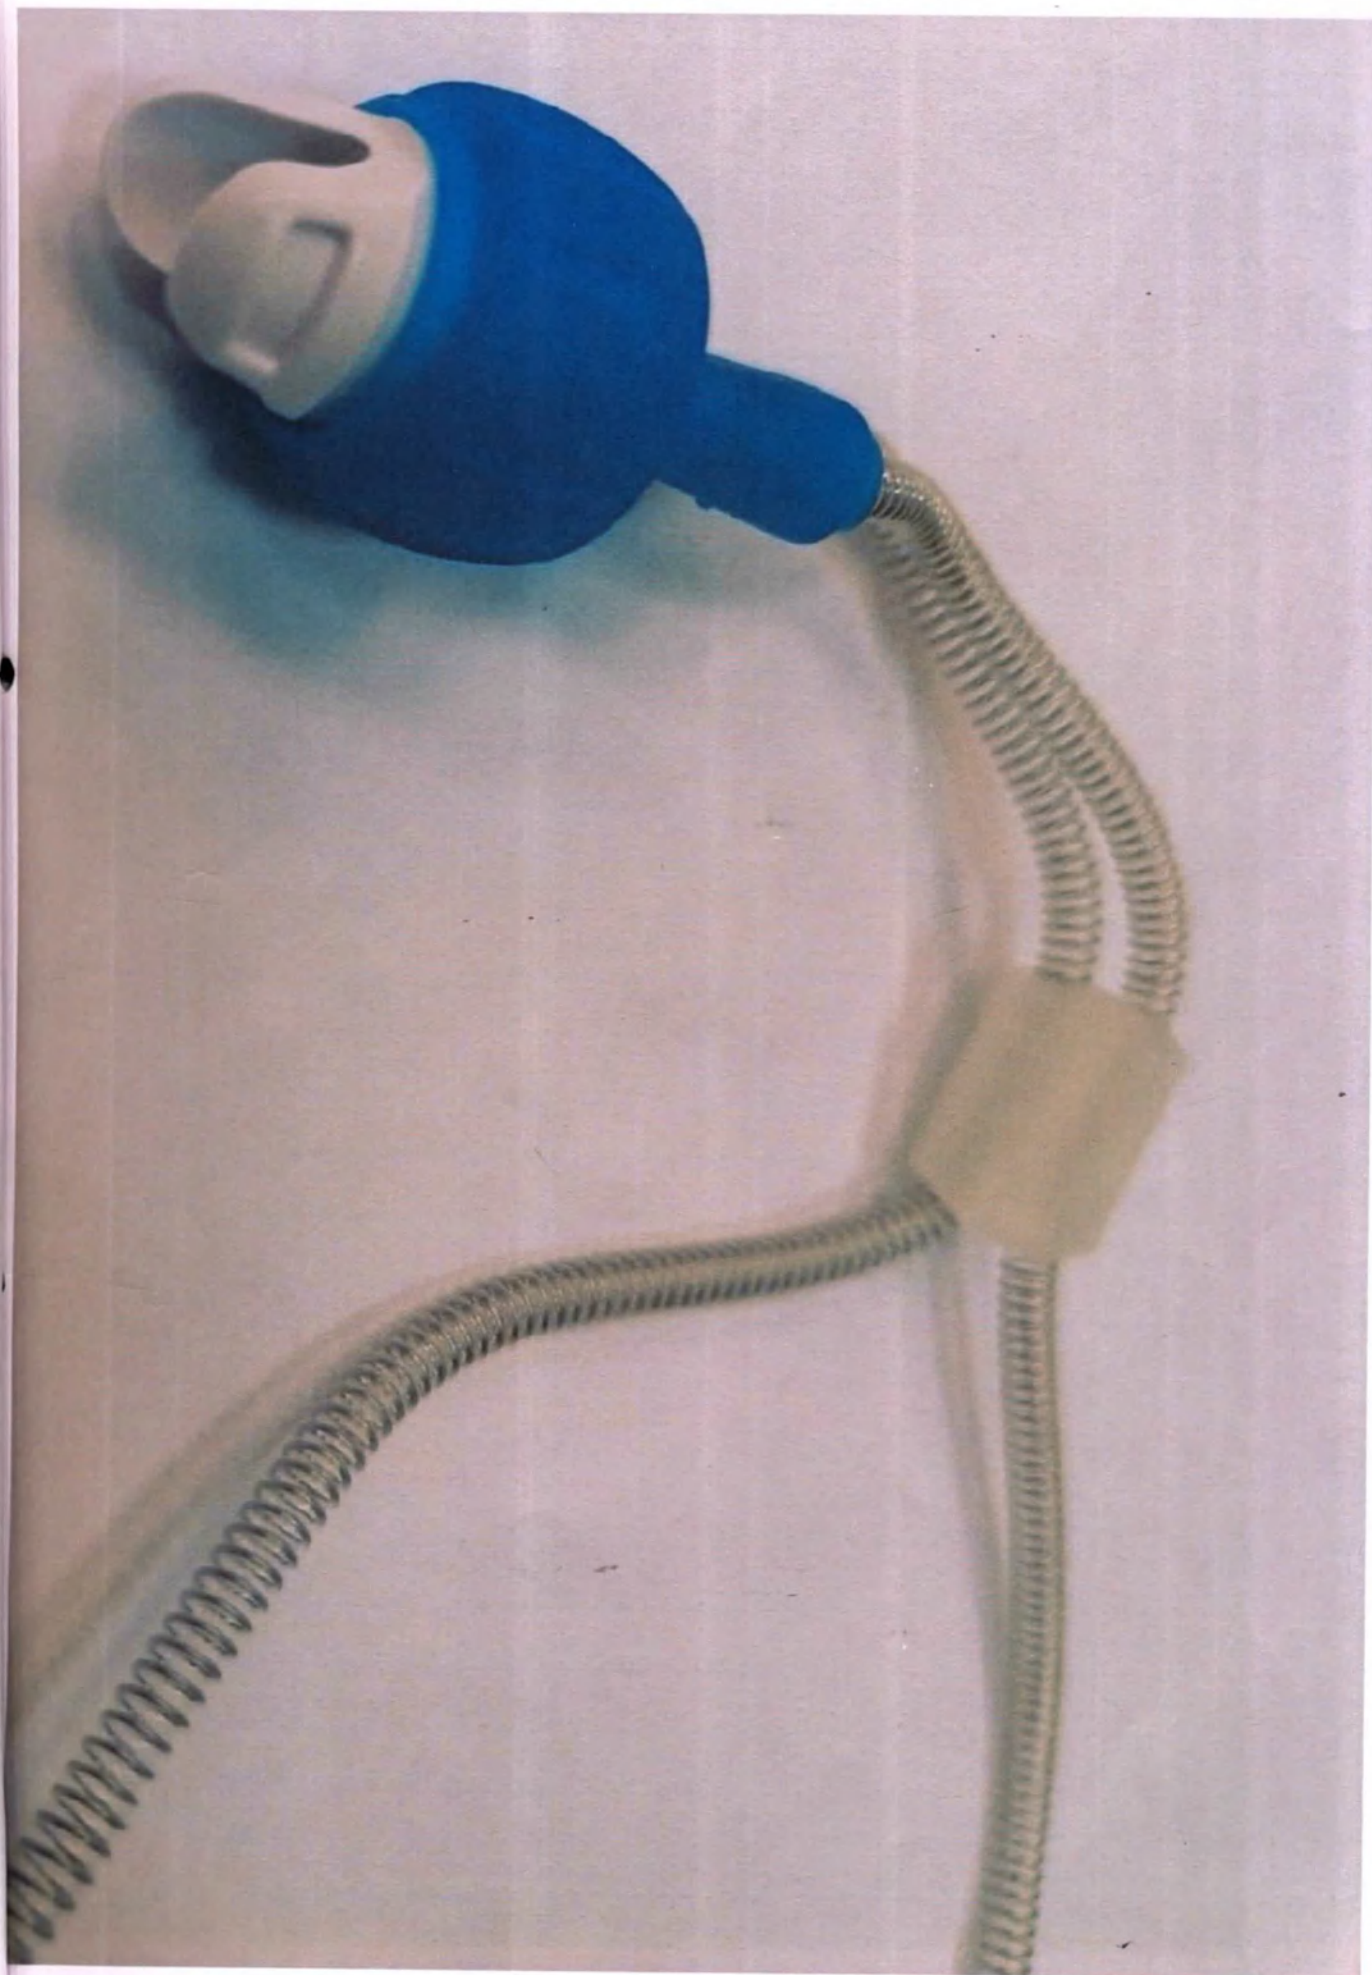


Рисунок 4. Внешний вид Канюли назальной Optiflow™ Junior 2 размера S

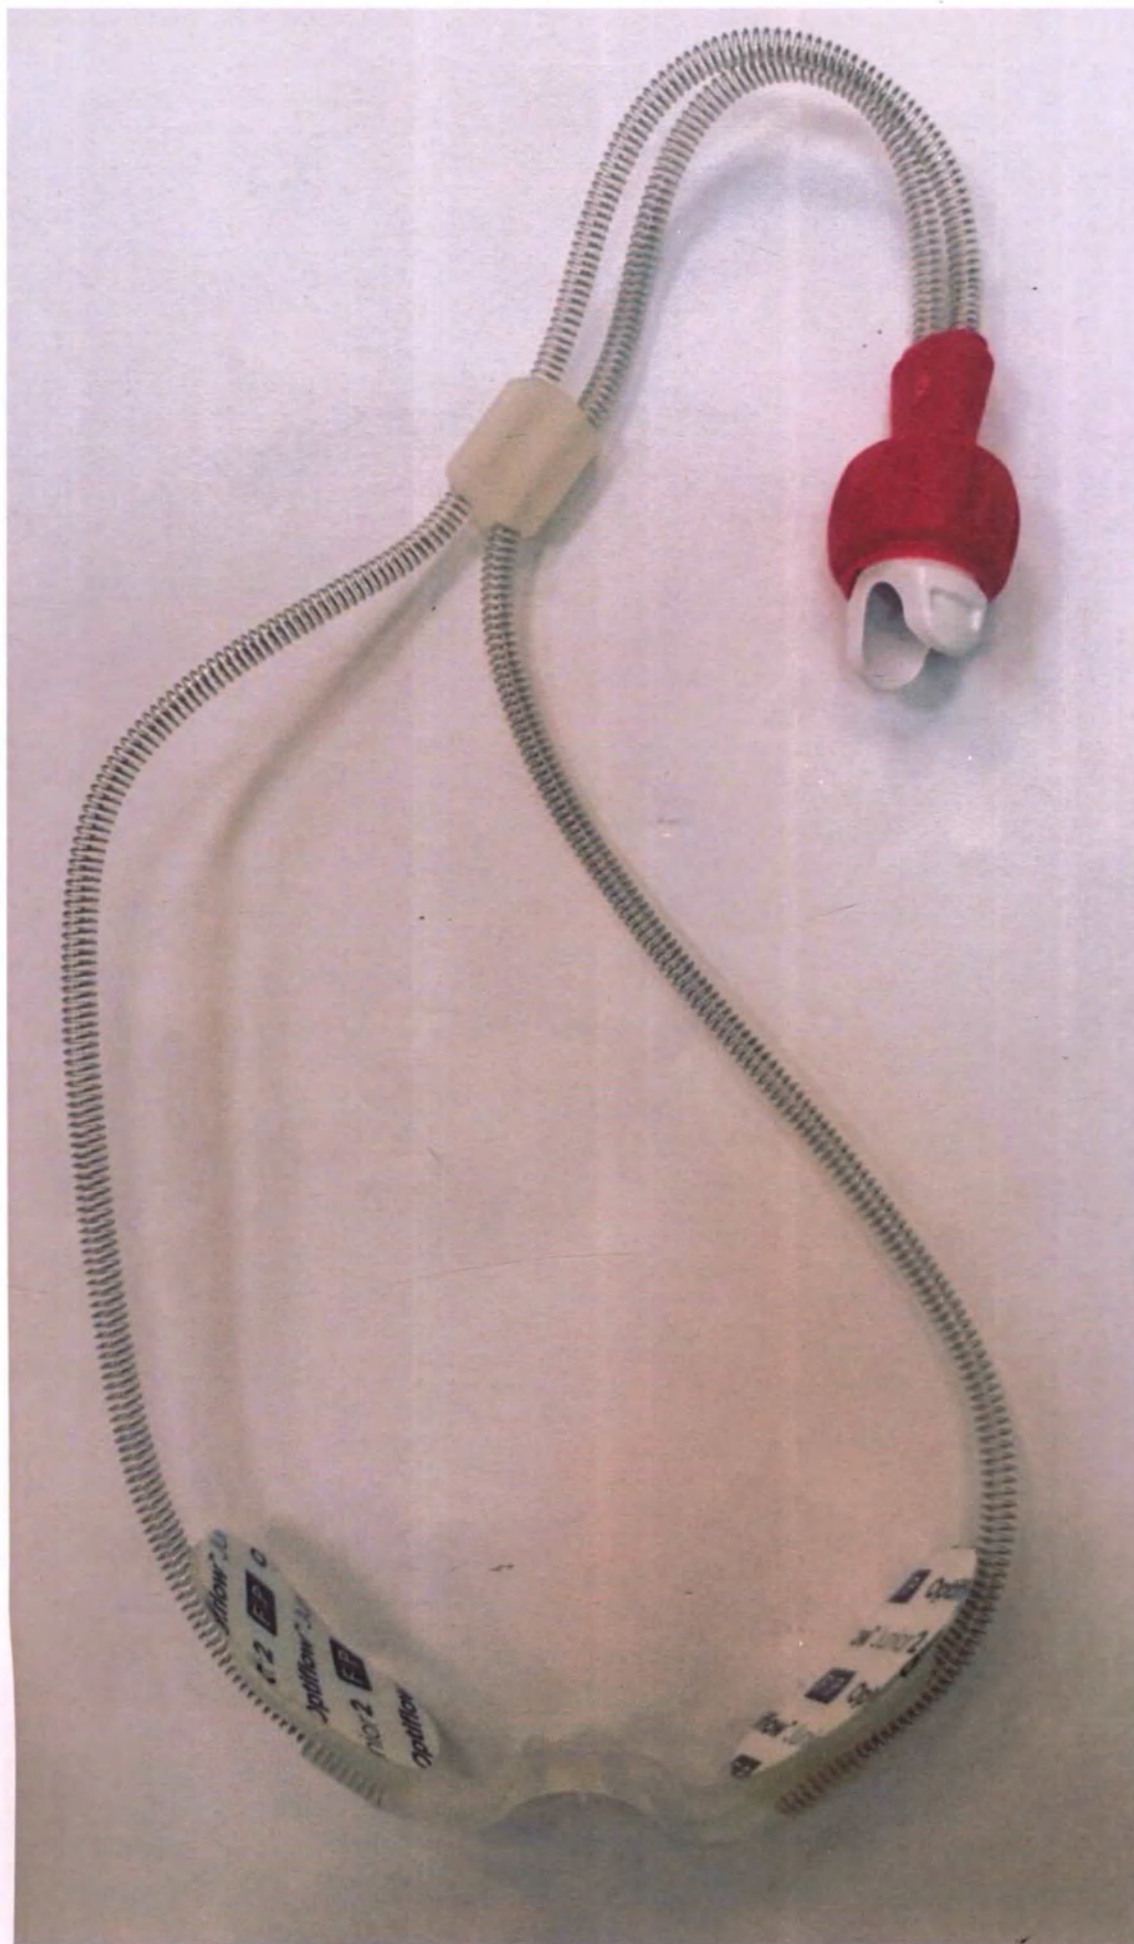


Рисунок 5 Внешний вид Канюли назальной Optiflow™ Junior 2 размера М



Рисунок 6. Внешний вид Канюли назальной Optiflow™ Junior 2 размера L

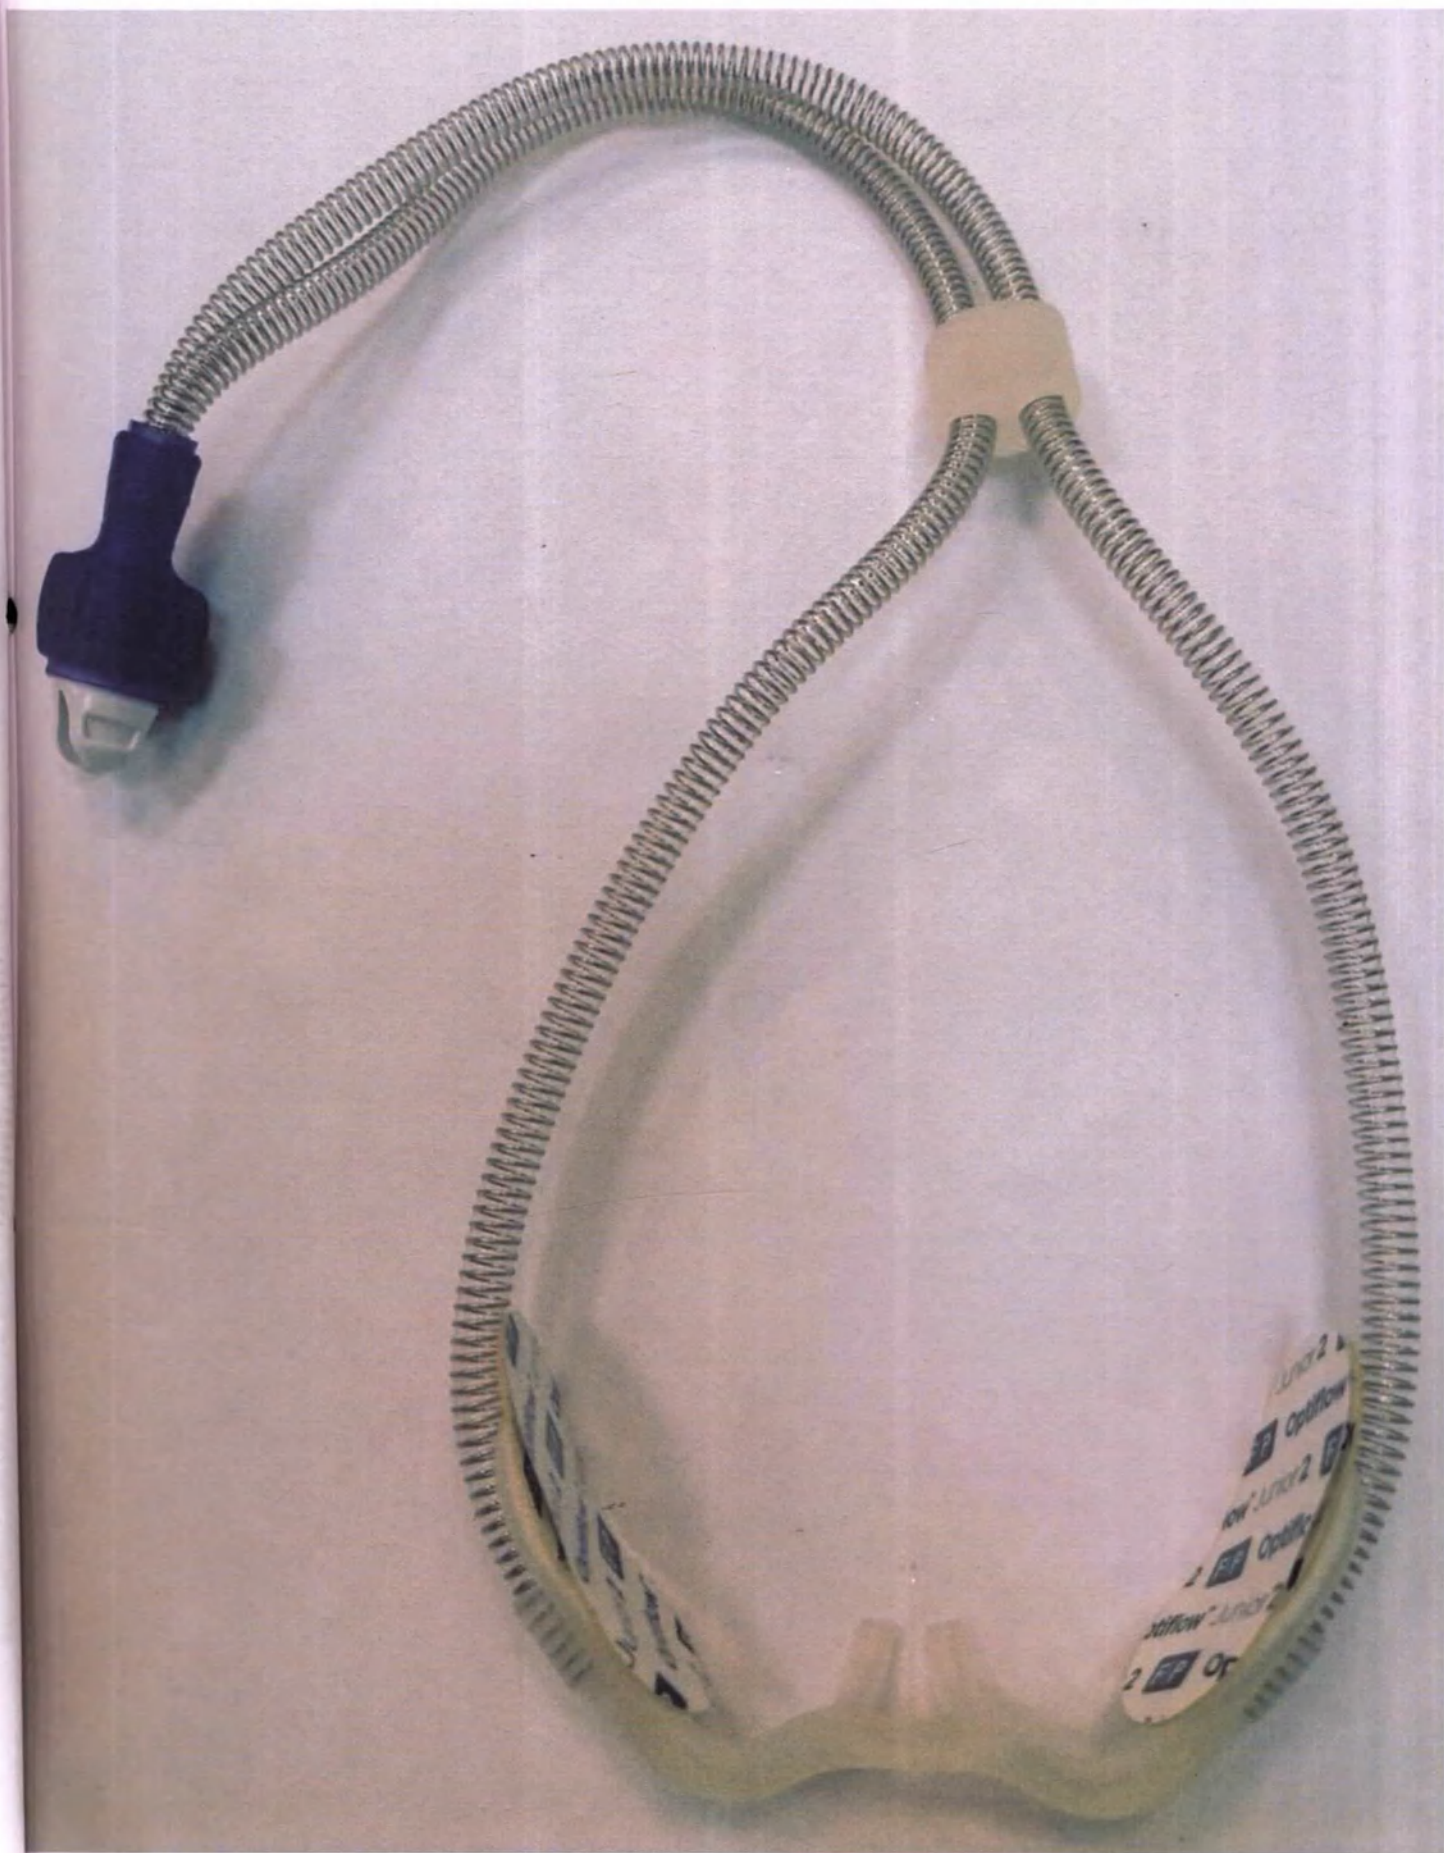


Рисунок 7. Внешний вид Канюли назальной Optiflow™ Junior 2 размера XL

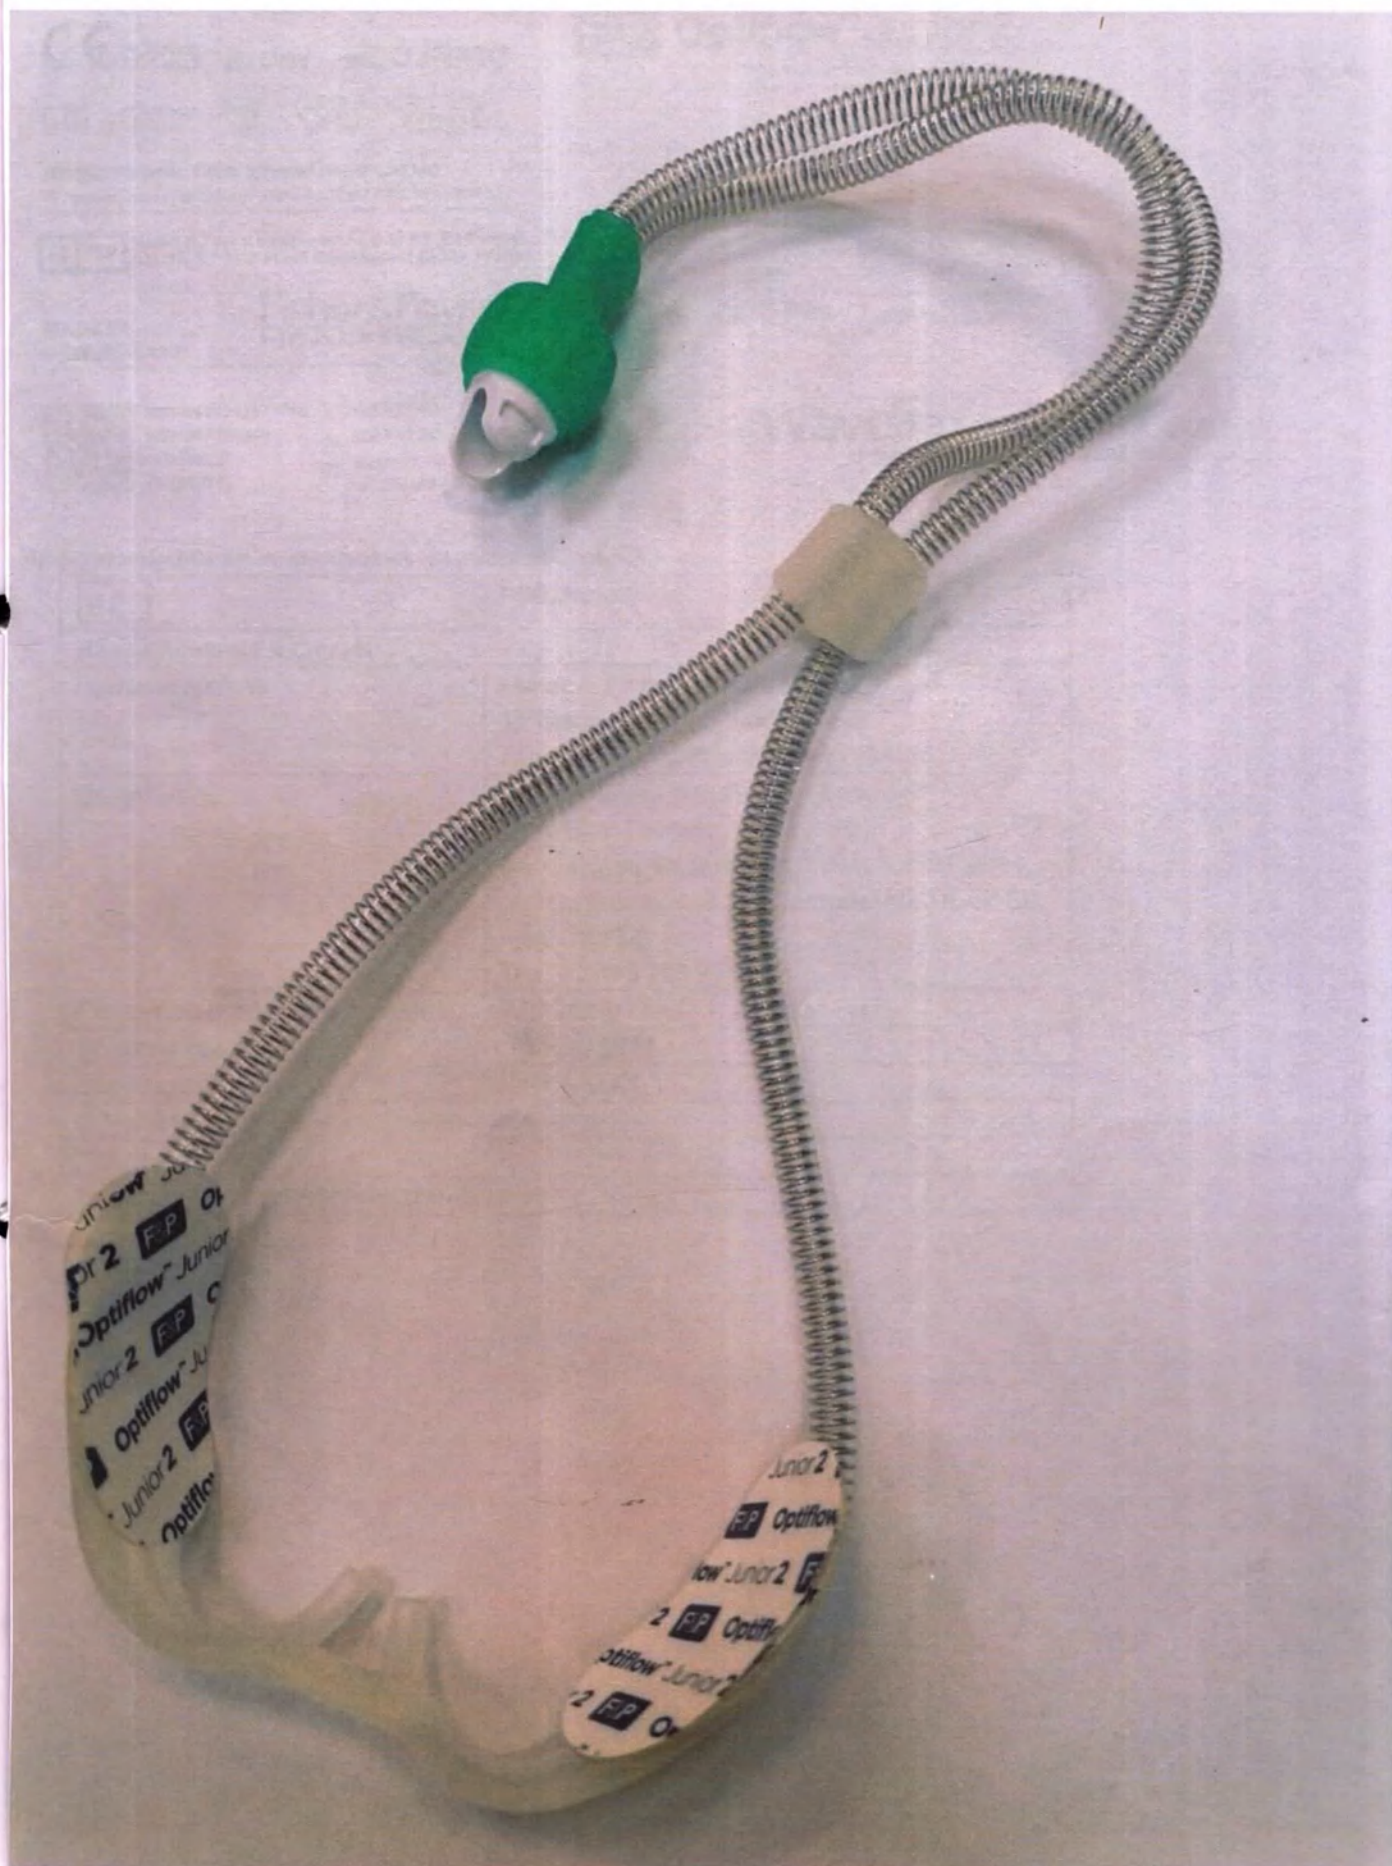


Рисунок 8. Маркировка изделия на индивидуальной упаковке, на примере маркировки варианта исполнения OJR410 (для остальных вариантов исполнения – аналогично)

CE 0123 Rx Only REF OJR410

Single Use



-10°C
(+14°F) to +50°C
(+122°F)

Manufacturer: Fisher & Paykel Healthcare Ltd

15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, New Zealand

EC REP

Fisher & Paykel Healthcare SAS 10 Av. du Québec,
Bât. F5, BP 512, 91946 Courtaboeuf Cedex, France

MADE IN
NEW ZEALAND





(01)09420012435743

(10)1907221234

(11)190722

(17)220722

2019-07-22

2022-07-22

LOT 1907221234

P/N: 608266_B

QTY: 1 EA

UOM: EA



F&P Optiflow™ Junior 2







Информационная маркировка на русском языке

REF	Реф. номер
Наименование изделия	
Производитель	Fisher & Paykel Healthcare Ltd. 15 Maurice Paykel Place East Tamaki, Auckland, New Zealand
Получатель	ООО "Фишер энд Пэйкел Хелскэр" 109428, г. Москва, Российская Федерация, 109428, г. Москва, просп. Рязанский, д. 10, строение 18, эт. 10, комн. № 7а. Тел. +7 495 782 21 50
Свидетельство о регистрации:	РЗН 202Х/XXXX ДД.ММ.ГГГГ
Условия хранения	- 10 до 50 °C
Срок годности до:	XX-XX-XXXX
Обратитесь к инструкции по применению	
Сделано в	
Изделие поставляется нестерильным	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 9 Индивидуальная упаковка изделия, на примере варианта исполнения OJR410 (для остальных вариантов исполнения – аналогично)



Рисунок 10. Маркировка изделия на групповой и транспортной упаковке, на примере маркировки варианта исполнения OJR412 (для остальных вариантов исполнения – аналогично)



Рисунок 11. Внешний вид Подушечек одинарных с адгезивной прокладкой Wigglepads 2 WJR112 в групповой упаковке с информационным стикере на русском языке (для WJR110 – аналогично)

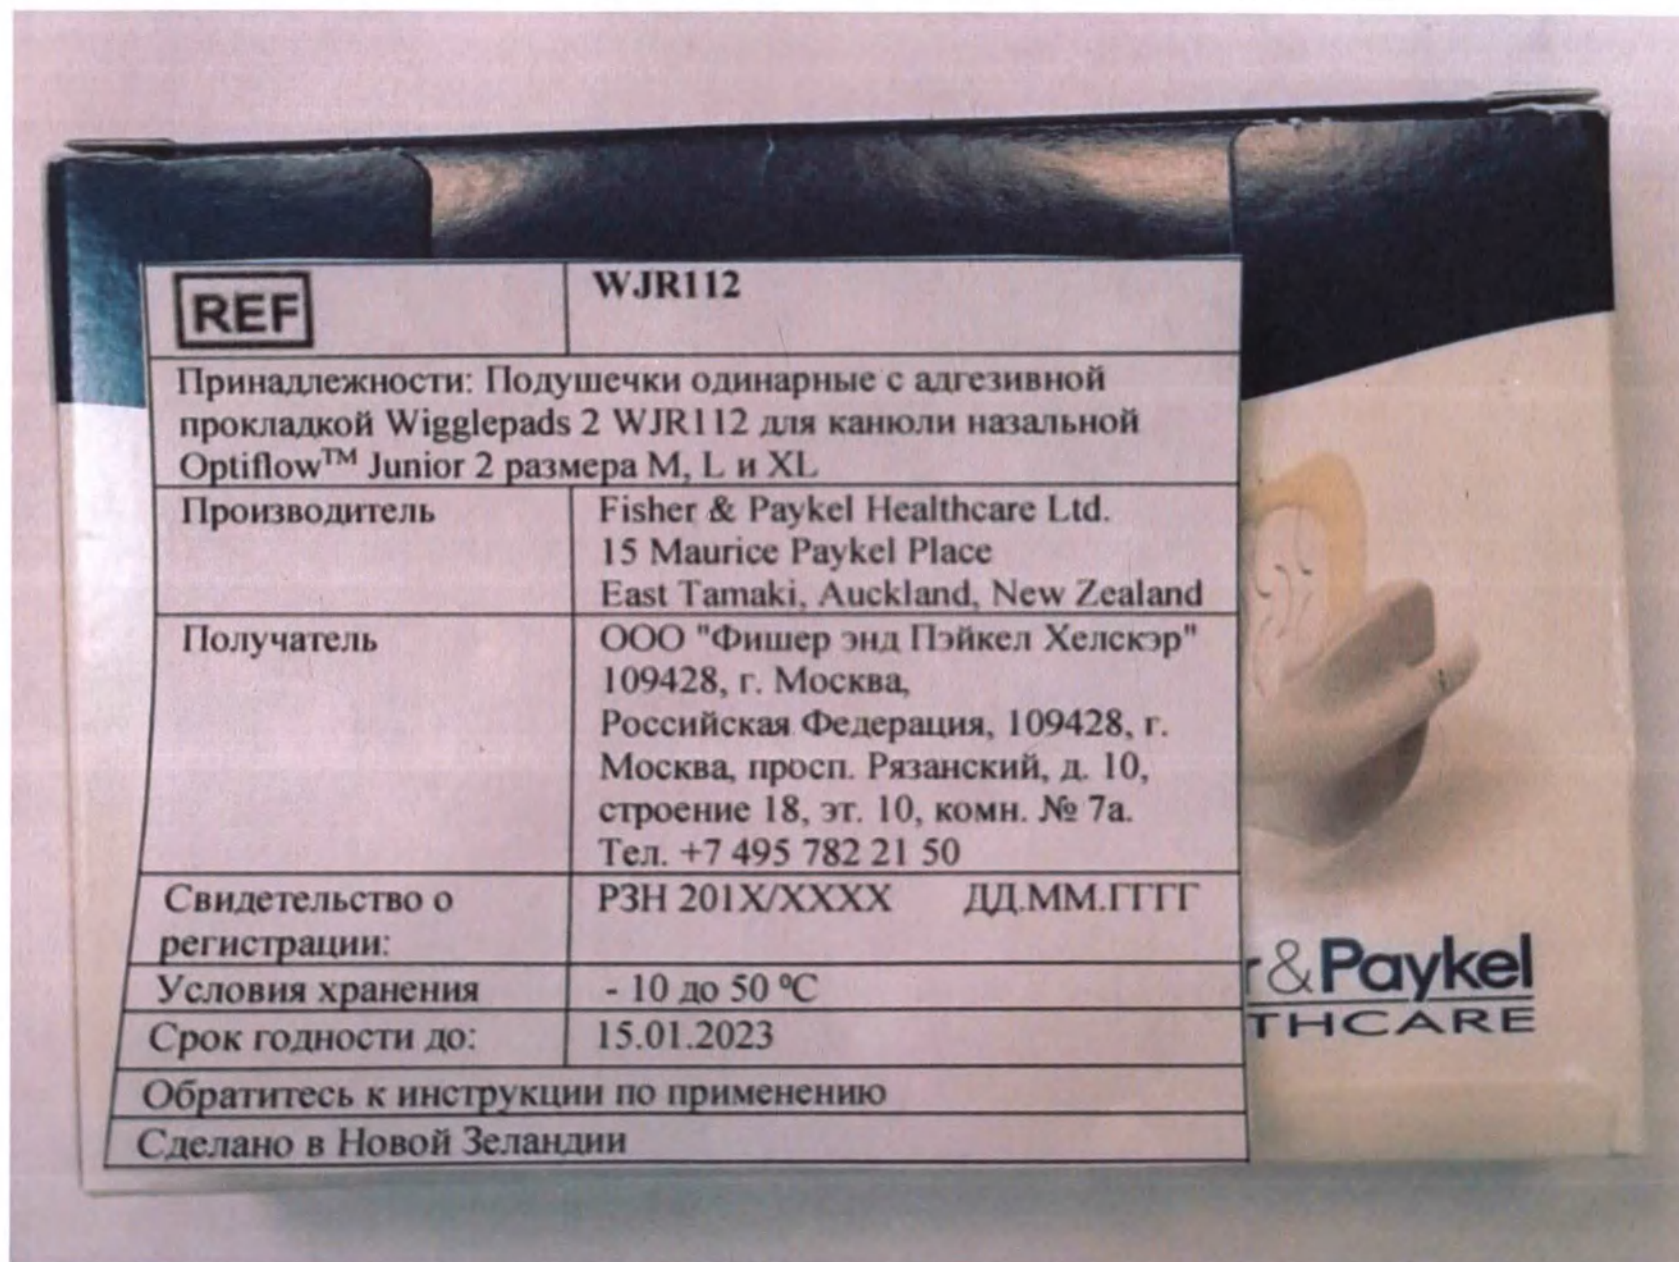


Рисунок 12. Внешний вид Подушечек одинарных с адгезивной прокладкой Wigglepads 2 WJR112 в потребительской упаковке (для WJR110 – аналогично)



Рисунок 13. Внешний вид Подушечек одинарных с адгезивной прокладкой Wigglepads 2 WJR210 в групповой упаковке с информационном стикере на русском языке (для WJR212 – аналогично)

REF	2102567391
Принадлежности: Подушечки двойные с адгезивной прокладкой WigglewiNG в варианте исполнения WJR210 для канюли назальной Optiflow™ Junior 2 размера XS и S	
Производитель	Fisher & Paykel Healthcare Ltd. 15 Maurice Paykel Place East Tamaki, Auckland, New Zealand
Получатель	ООО "Фишер энд Пэйкел Хелскэр" 109428, г. Москва, Российская Федерация, 109428, г. Москва, просп. Рязанский, д. 10, строение 18, эт. 10, комн. № 7а. Тел. +7 495 782 21 50
Свидетельство о регистрации:	РЗН 202Х/XXXX ДД.ММ.ГГГГ
Условия хранения	- 10 до 50 °С
Срок годности до:	08-02-2026
Обратитесь к инструкции по применению	
Сделано в	
Изделие поставляется нестерильным	

Рисунок 14. Внешний вид Подушечек одинарных с адгезивной прокладкой Wigglepads 2 WJR212 в потребительской упаковке (для WJR210 – аналогично)



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

15 (пятнадцать) листа

цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись _____

" 10 "

Филиппов А.А.

2024 г. 10.11.2024

