

Согласовано

ООО «ЦИСЗ»

Организация

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2,
эт/ком/оф 2/30,32/232

Адрес

Генеральный директор

Должность

Ширшов К.Г.

Фамилия, Имя

«07» августа 2024 года
Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись



Фотографические изображения

Катетер баллонный дилатационный РТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики в вариантах исполнения


2024

Shunmei®
Medical technology creates future

MD PTA balloon dilatation catheter OTW

2.0 x 20

mm	mm
D-Diameter	L-Length
1.0	1.0
1.5	1.5
2.0	2.0
2.5	2.5
3.0	3.0
3.5	3.5
4.0	4.0
4.5	4.5
5.0	5.0
5.5	5.5
6.0	6.0
6.5	6.5
7.0	7.0
7.5	7.5
8.0	8.0
8.5	8.5
9.0	9.0
9.5	9.5
10.0	10.0
10.5	10.5
11.0	11.0
11.5	11.5
12.0	12.0
12.5	12.5
13.0	13.0
13.5	13.5
14.0	14.0
14.5	14.5
15.0	15.0
15.5	15.5
16.0	16.0
16.5	16.5
17.0	17.0
17.5	17.5
18.0	18.0
18.5	18.5
19.0	19.0
19.5	19.5
20.0	20.0
20.5	20.5
21.0	21.0
21.5	21.5
22.0	22.0
22.5	22.5
23.0	23.0
23.5	23.5
24.0	24.0
24.5	24.5
25.0	25.0
25.5	25.5
26.0	26.0
26.5	26.5
27.0	27.0
27.5	27.5
28.0	28.0
28.5	28.5
29.0	29.0
29.5	29.5
30.0	30.0
30.5	30.5
31.0	31.0
31.5	31.5
32.0	32.0
32.5	32.5
33.0	33.0
33.5	33.5
34.0	34.0
34.5	34.5
35.0	35.0
35.5	35.5
36.0	36.0
36.5	36.5
37.0	37.0
37.5	37.5
38.0	38.0
38.5	38.5
39.0	39.0
39.5	39.5
40.0	40.0
40.5	40.5
41.0	41.0
41.5	41.5
42.0	42.0
42.5	42.5
43.0	43.0
43.5	43.5
44.0	44.0
44.5	44.5
45.0	45.0
45.5	45.5
46.0	46.0
46.5	46.5
47.0	47.0
47.5	47.5
48.0	48.0
48.5	48.5
49.0	49.0
49.5	49.5
50.0	50.0
50.5	50.5
51.0	51.0
51.5	51.5
52.0	52.0
52.5	52.5
53.0	53.0
53.5	53.5
54.0	54.0
54.5	54.5
55.0	55.0
55.5	55.5
56.0	56.0
56.5	56.5
57.0	57.0
57.5	57.5
58.0	58.0
58.5	58.5
59.0	59.0
59.5	59.5
60.0	60.0
60.5	60.5
61.0	61.0
61.5	61.5
62.0	62.0
62.5	62.5
63.0	63.0
63.5	63.5
64.0	64.0
64.5	64.5
65.0	65.0
65.5	65.5
66.0	66.0
66.5	66.5
67.0	67.0
67.5	67.5
68.0	68.0
68.5	68.5
69.0	69.0
69.5	69.5
70.0	70.0
70.5	70.5
71.0	71.0
71.5	71.5
72.0	72.0
72.5	72.5
73.0	73.0
73.5	73.5
74.0	74.0
74.5	74.5
75.0	75.0
75.5	75.5
76.0	76.0

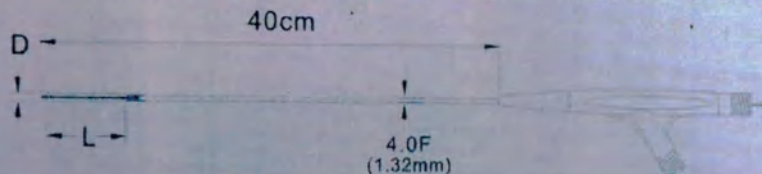

Pressure		Balloon Diameter
kPa	atm	mm
405	4	1.94
608	6	2.00
810	8	2.06
1013	10	2.13
1216	12	2.19
1418	14	2.25
1621	16	2.32

GALLOON ϕ 2.0mm

BALLOON $\pm$ 20mm $\pm$

REF 628325

LOI 2407045L

202407

202706

 Shunmei Medical Co., Ltd

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China

Factory:

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,

Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Tel:+0086-0752-3306949

Email:nora@shunmed.com

Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,

The Hague, Netherlands.

Tel: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com

SM-LB-POTW-001,A.1

Effective date: 2024.05.21

Storage conditions: Temperature: 0-40°C, Humidity: 0-80%

PTA Balloon

POTW2.0x20x40



UDI (01)06956014483251



(17)202706(10)2407045L

REF 628325

LOT 2407045L

PTA Balloon

POTW2.0x20x40



UDI (01)0695601448325



(17)202706(10)2407045

QY 2407045U



CE 2696

made in China

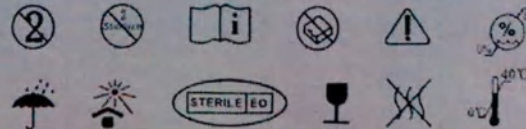


Рис. 2. Катетер баллонный дилатационный ПТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 2,0 x 20 мм, эффективная длина 40 см

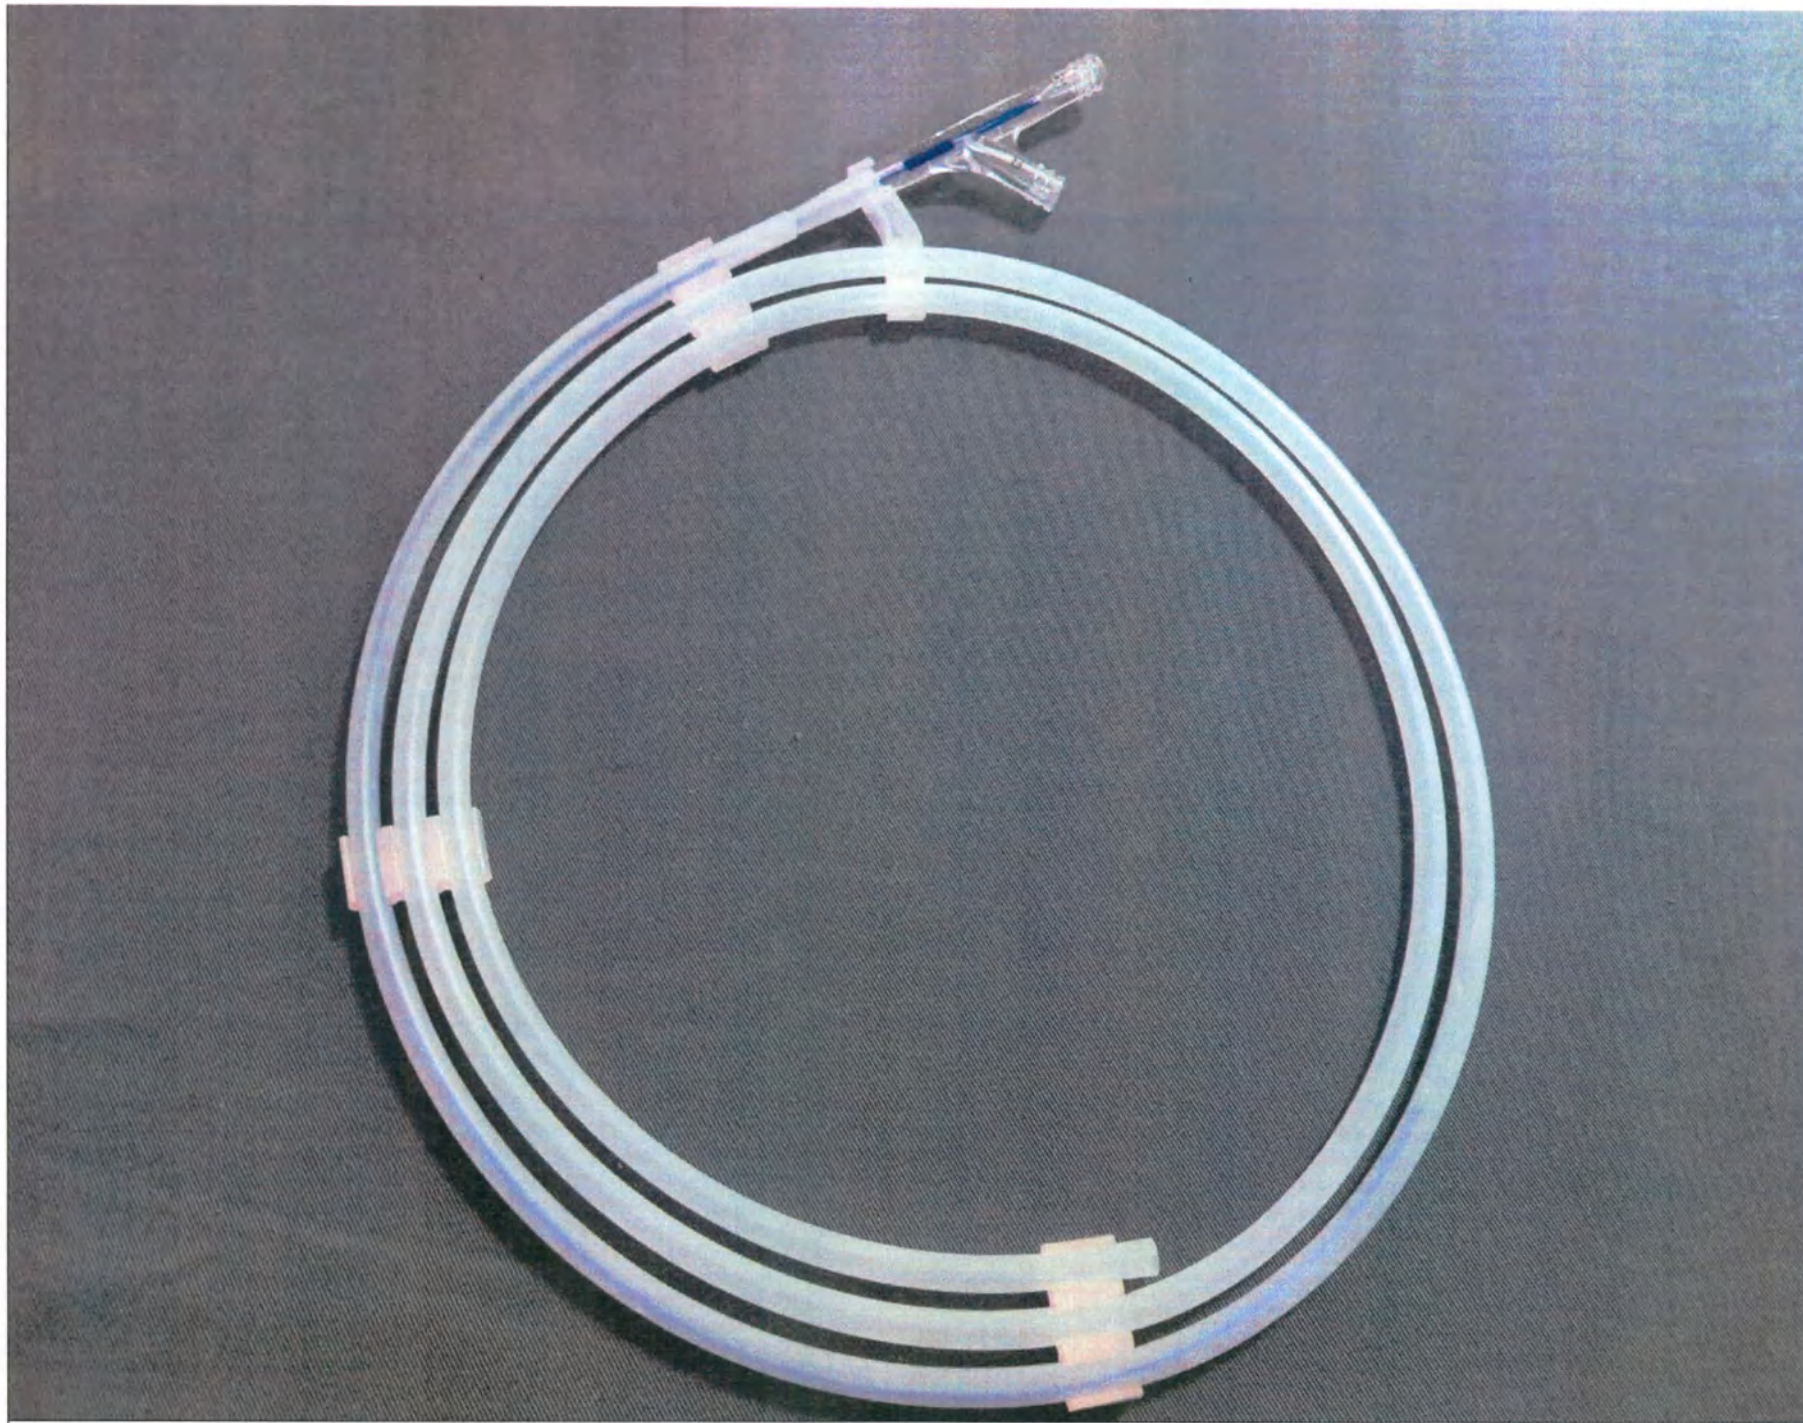


Рис. 3. Катетер баллонный дилатационный ПТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 2,0 x 20 мм, эффективная длина 40 см

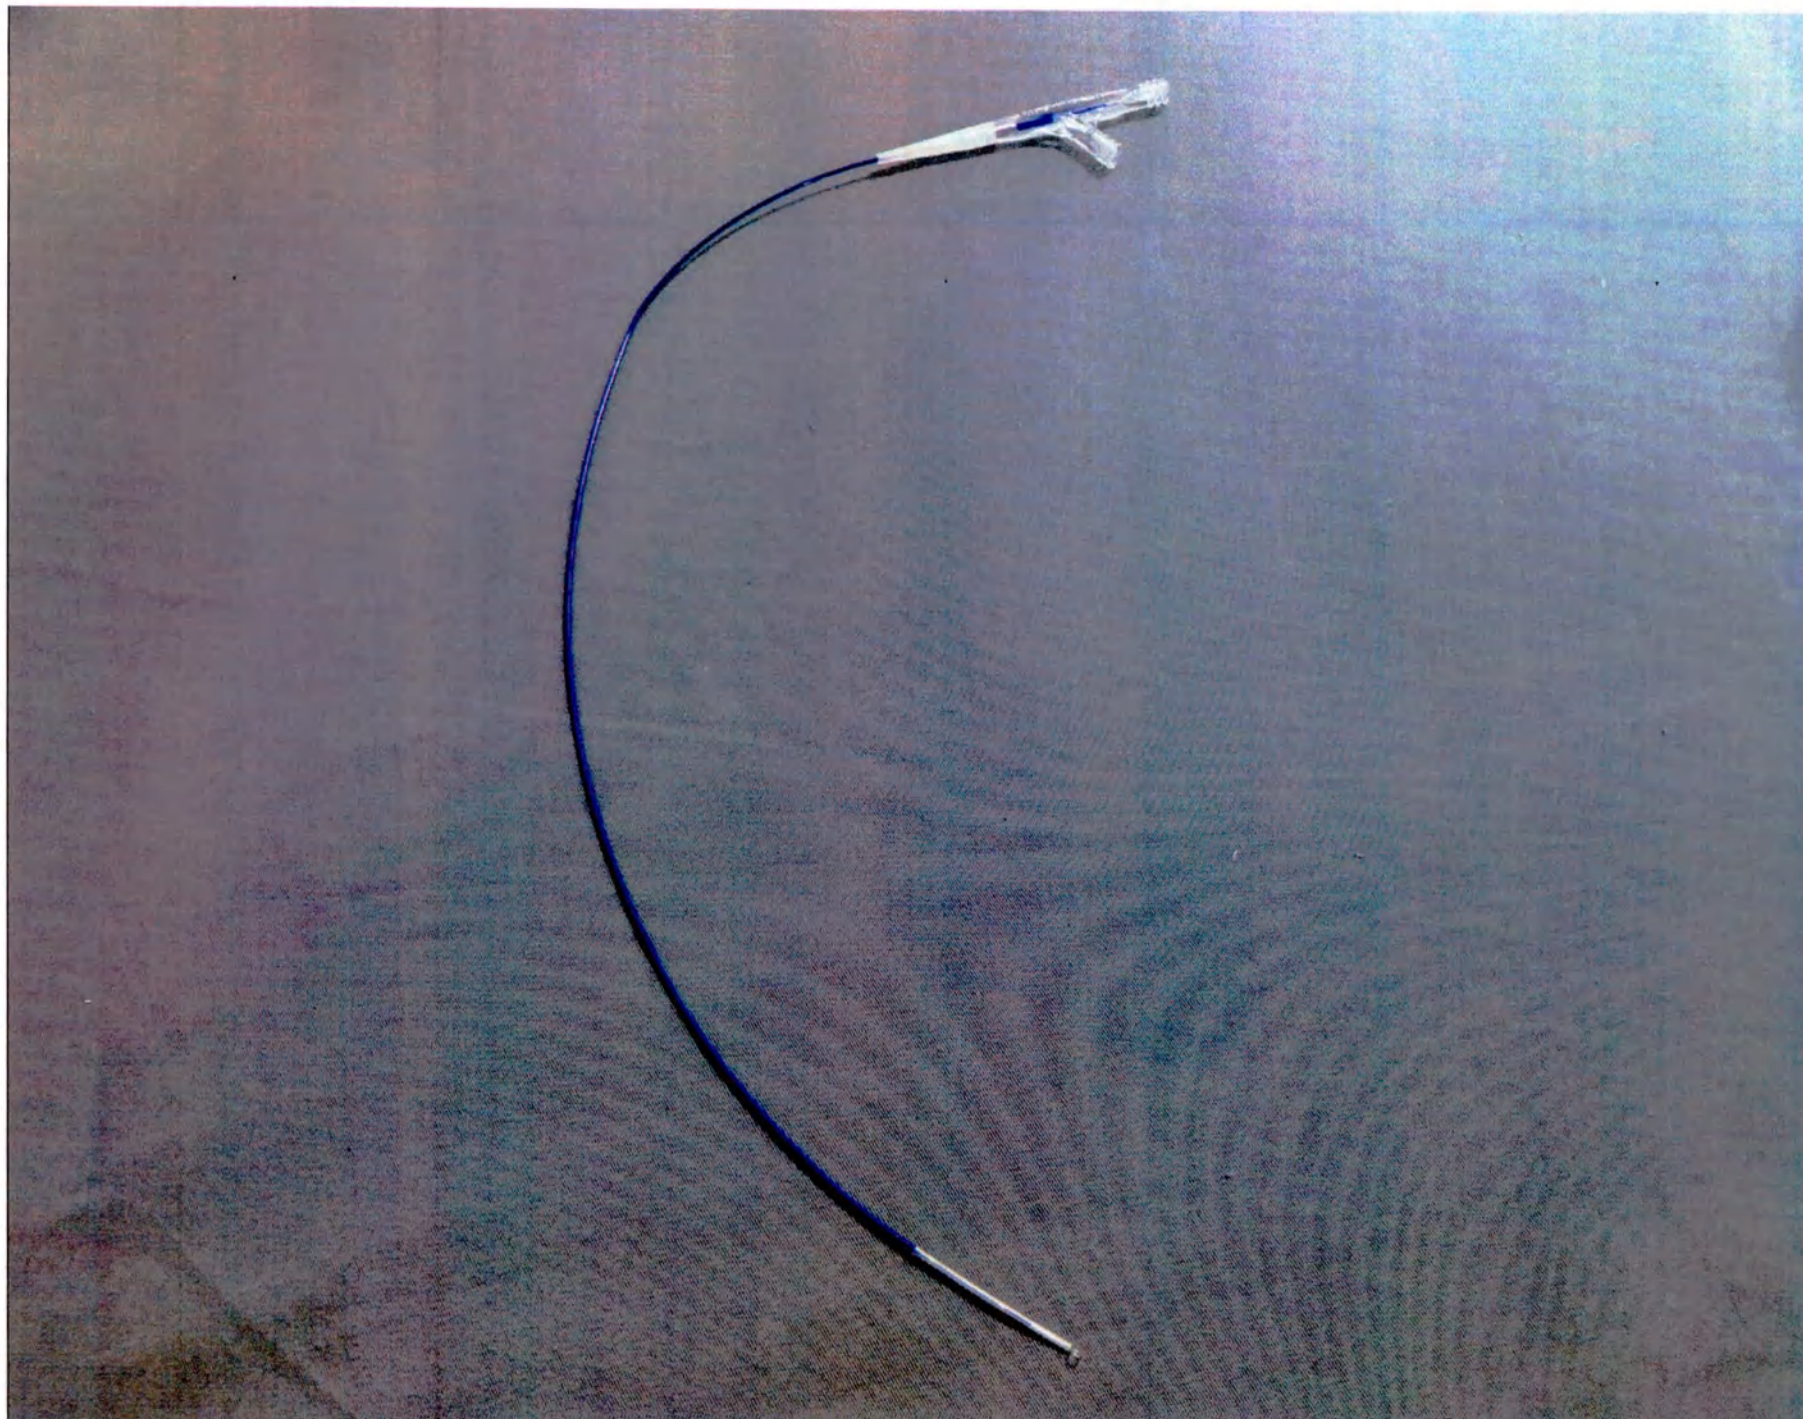


Рис. 4. Катетер баллонный дилатационный РТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 2,0 x 20 мм, эффективная длина 40 см

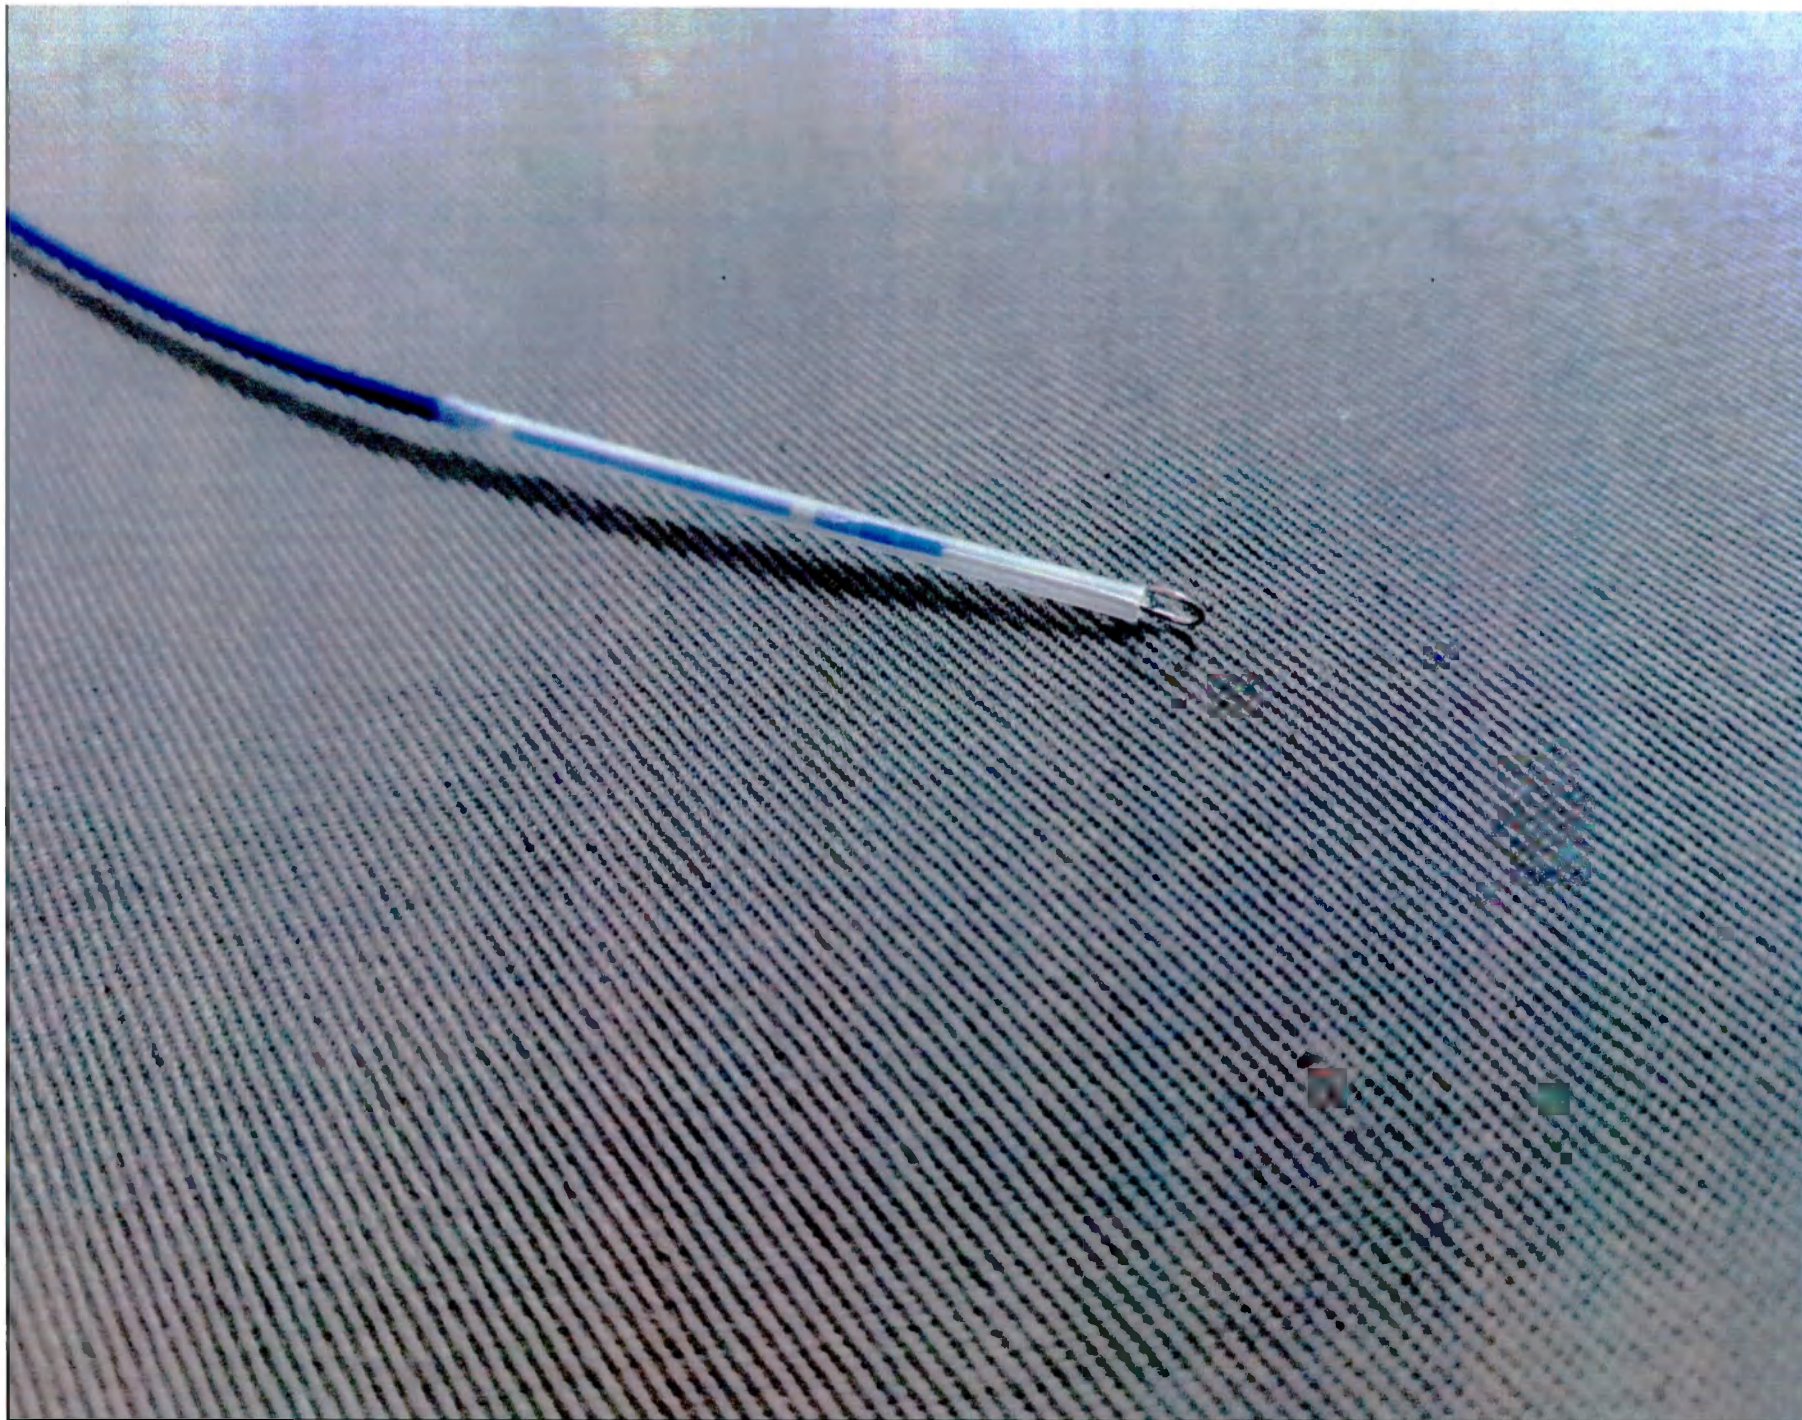


Рис. 5. Катетер баллонный дилатационный РТА Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 2,0 x 20 мм, эффективная длина 40 см

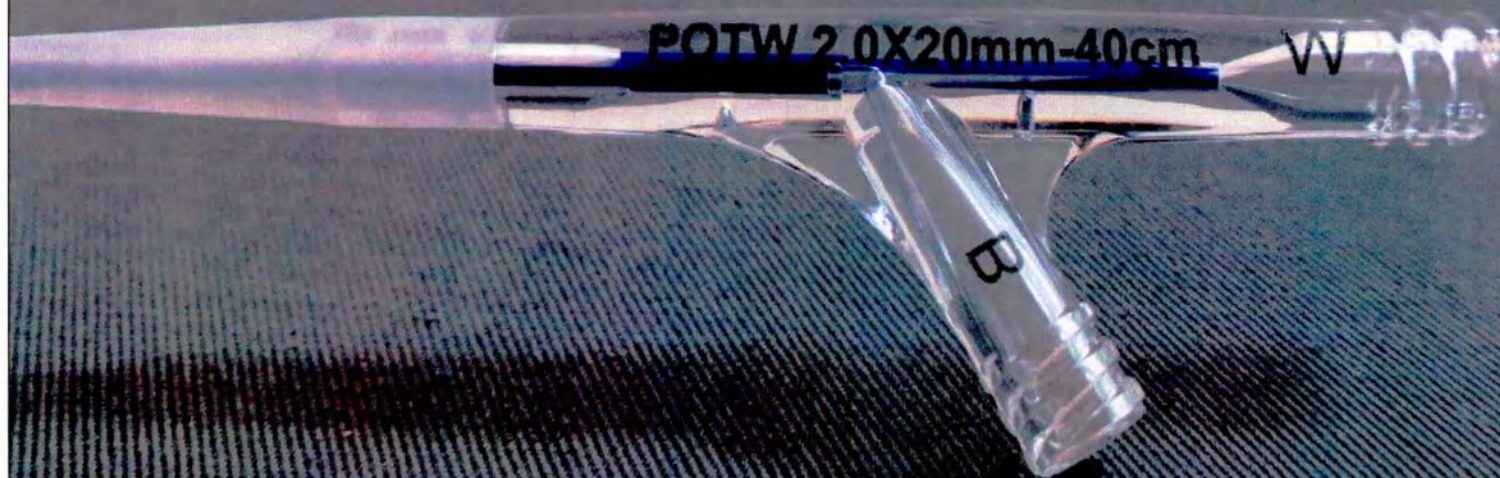



Рис. 6. Катетер баллонный дилатационный ПТА Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 2,0 x 20 мм, эффективная длина 40 см

Shunmei[®]
Medical technology creates future

Shun Sofer
PTA balloon dilatation catheter OTW

4.0 x 300

mm mm
D-Diameter L-Length

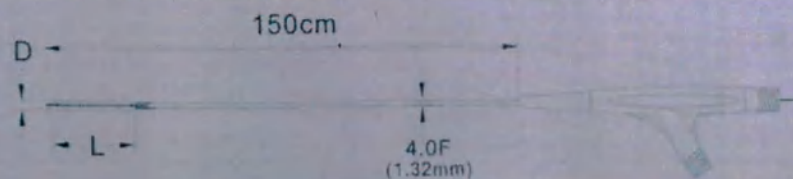

Pressure		Balloon Diameter
kPa	atm	
405	4	3.89
608	6	NP 4.00
810	8	4.13
1013	10	4.24
1216	12	4.31
1418	14	RBP 4.38
1621	16	4.50

BALLOON	φ 4.0mm
BALLOON	300mm
REF	628459
LOT	2407045L
	202407
	202706

Shunmei Medical Co., Ltd
Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory:
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com

SM-LB-POTW-001, A.1
Effective date: 2024.05.21
Storage conditions: Temperature: 0-40°C, Humidity: 0-80%

CE 2696 made in China



PTA Balloon POTW4.0x300x150



PTA Balloon POTW4.0x300x150

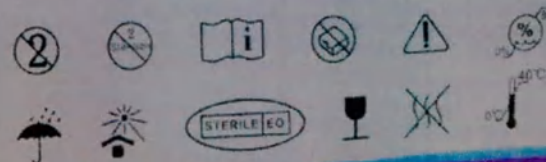


Рис. 7. Катетер баллонный дилатационный PTA Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 4,0 x 300 мм, эффективная длина 150 см



Рис. 8. Катетер баллонный дилатационный ПТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 4,0 x 300 мм, эффективная длина 150 см

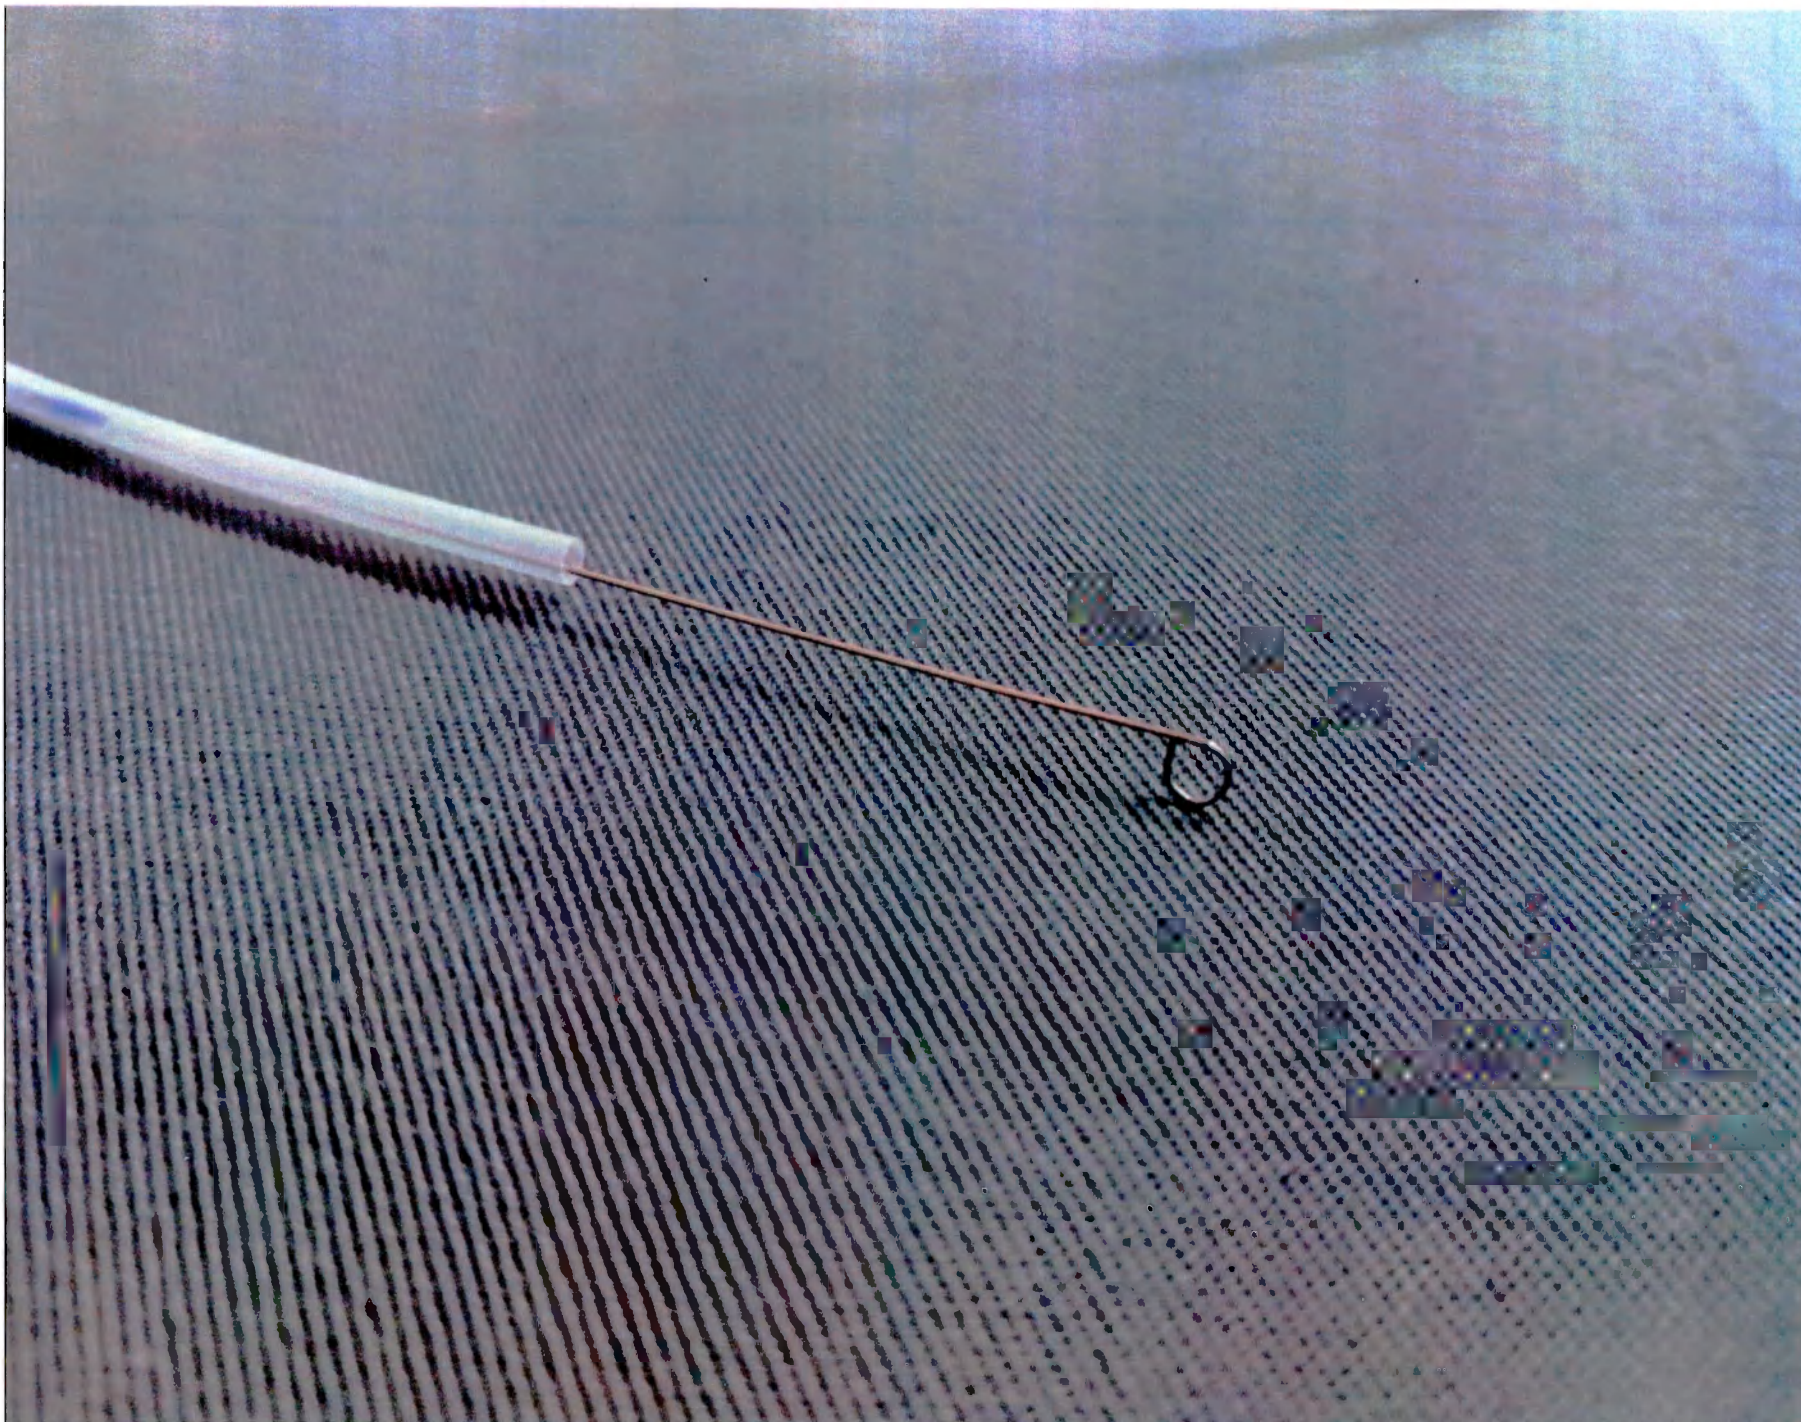


Рис. 9. Катетер баллонный дилатационный РТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 4,0 x 300 мм, эффективная длина 150 см

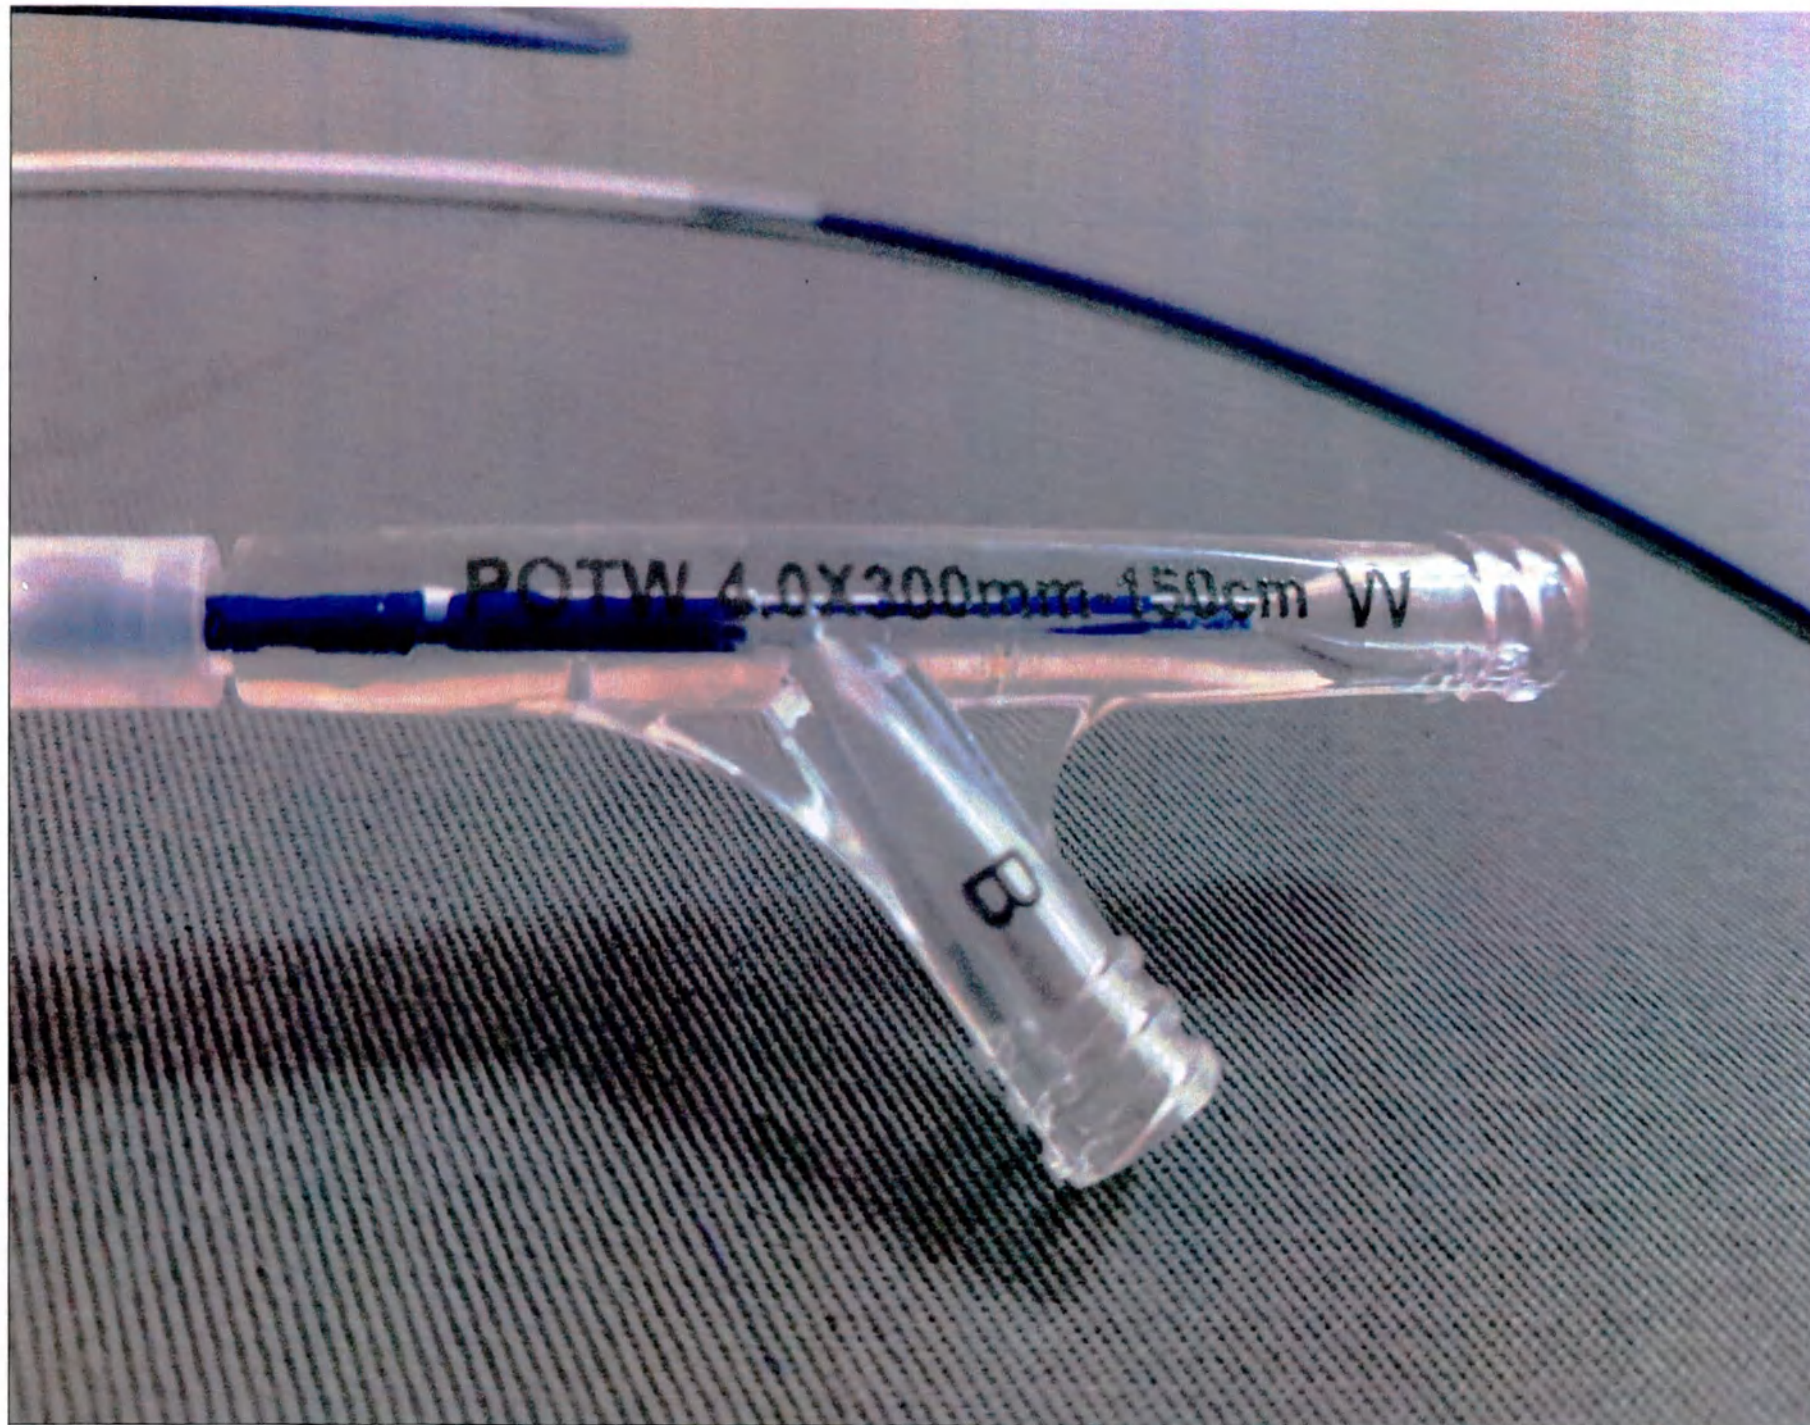



Рис. 10. Катетер баллонный дилатационный ПТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 4,0 x 300 мм, эффективная длина 150 см

Shunmei
Medical technology creates future

Shun Sofer
PTA balloon dilatation catheter OTW

7.0 x 200

mm mm
D-Diameter L-Length

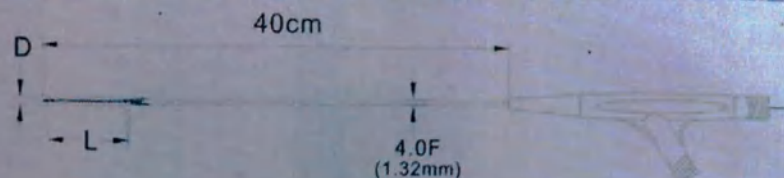

Pressure

kPa	atm	Balloon Diameter mm
405	4	6.87
608	6	7.00
810	8	7.17
1013	10	7.31
1216	12	7.42
1418	14	7.53
1621	16	7.62

φ 7.0mm

200mm

REF 629289

LOT 2407045L

202407

202706

Shunmei Medical Co., Ltd

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China

Factory:

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Tel: +0086-0752-3306949

Email: nora@shunmed.com

Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.

Tel: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com

SM-LB-POTW-001,A.1

Effective date: 2024.05.21

Storage conditions: Temperature: 0-40°C, Humidity: 0-80%

CE 2696

made in China



PTA Balloon

POTW7.0x200x40

UDI

(01)06956014492895

(17)202706(10)2407045L

REF 629289

LOT 2407045L

PTA Balloon

POTW7.0x200x40

UDI

(01)06956014492895

(17)202706(10)2407045L

REF 629289

LOT 2407045L



Рис. 11. Катетер баллонный дилатационный PTA Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 7,0 x 200 мм, эффективная длина 40 см

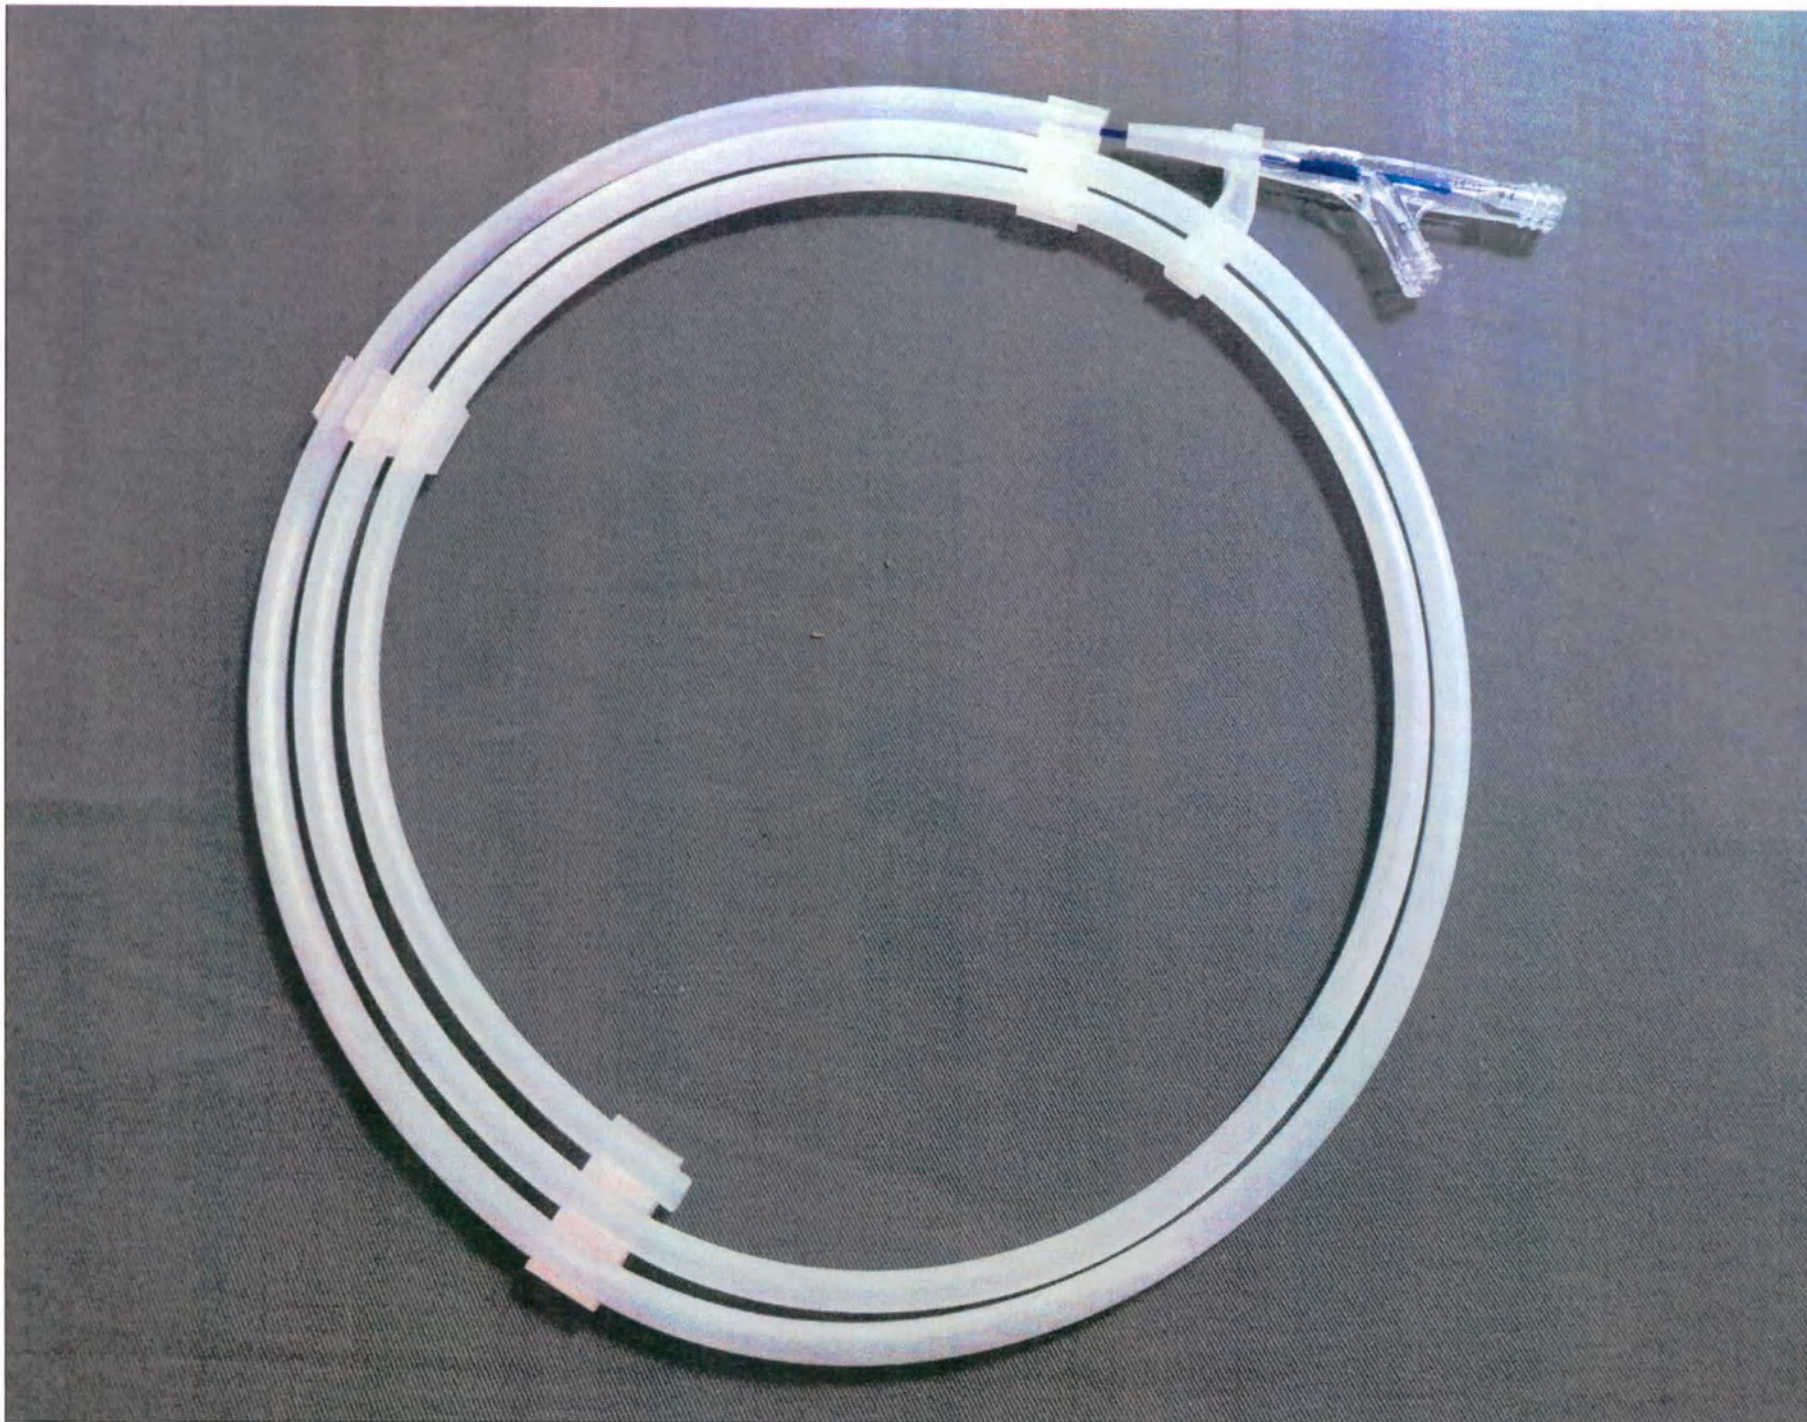


Рис. 12. Катетер баллонный дилатационный ПТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 7,0 x 200 мм, эффективная длина 40 см

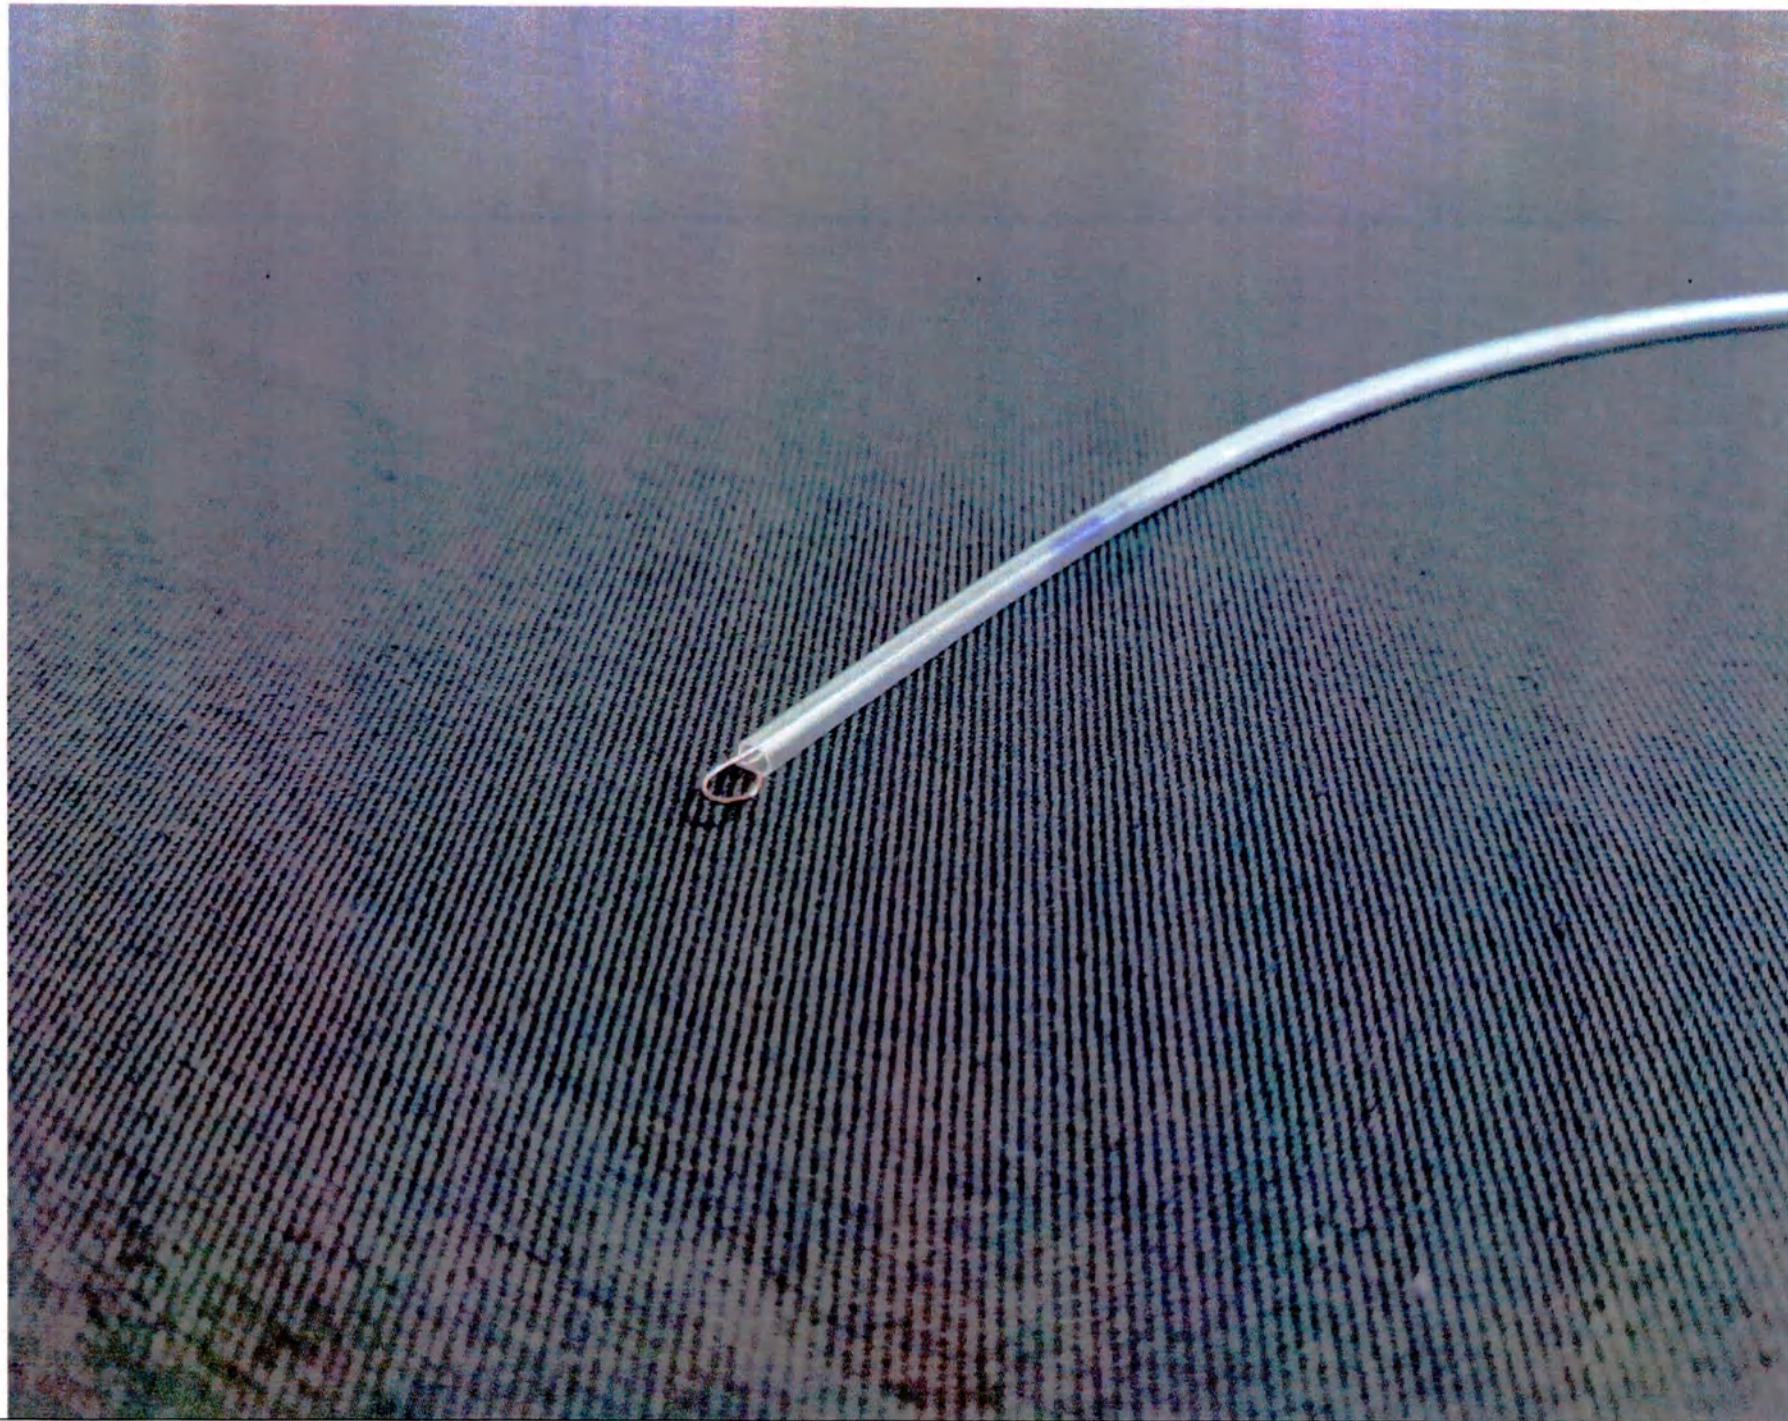


Рис. 13. Катетер баллонный дилатационный РТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 7,0 x 200 мм, эффективная длина 40 см



Рис. 14. Катетер баллонный дилатационный ПТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона 7,0 x 200 мм, эффективная длина 40 см

Согласовано/APPROVED


Shunmei Medical Co., Ltd
Организация/Organization

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong
Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District,
518116 Shenzhen, Guangdong, China
Адрес/Address

General Manager
Должность/Occupation

Tu Zhenjin
Фамилия, Имя/ Surname, Name

27.05.2024
Дата ДД.ММ.ГГГГ/Date DD.MM.YYYY



Инструкция по применению на медицинское изделие:
«Катетер баллонный дилатационный PTA Shunmei для чрескожной транслюминальной
ангиопластики в вариантах исполнения»
Instruction for use
«PTA Balloon Dilatation Catheter Shunmei in variations»

2024

Рис. 15. Инструкция по применению

Shunmei®

Medical technology creates future


Shunmei® Shun Sofer OTW

PTA balloon dilatation catheter

2.0x20

mm mm

D-Diameter L-Length



SIZE	2.0mm
SIZE	20mm
LOT	628325
LOT	2407045L
LOT	202407
LOT	202706



Shunmei Medical Co., Ltd
Head Office: 2nd Floor and 3rd Floor of Building 9,
No. 8 of Yuezhong Road, Jiaxing Industrial Zone,
Longxing District, 513136 Shimen, Guangdong, China
Factory:
Wu Jie Road, 11th Industrial Zone, Pingtan Town,
Hailing District, Jiaxing Industrial Zone,
Longxing District, 513136 Shimen, Guangdong, China
Tel: +86-573-2012-1888
Email: sales@shunmei.com
Web: www.shunmei.com

Pressure		Balloon Diameter
ATM	KPA	(mm)
4	405	1.94
6	810	2.05
10	1013	2.13
12	1216	2.19
16	1821	2.32

Do not exceed the rated burst pressure (RBP)

EC REP Lotus NL B.V.
Koningin Adolaplein 10, 1e verd, 2519AA,
The Hague, Netherlands
Tel: +31-70-4416999
Email: sales@lotusnl.com
made in China
SM-19-PTW-001.A.1
Effective date: 2024/05/23
Storage conditions: Temperature:
0-40°C, humidity: 2-90%

CE
2696



POTW 2.0 x 20
Shun Sofer mm mm

PTA balloon dilatation catheter




Рис. 16. Пример вторичной упаковки

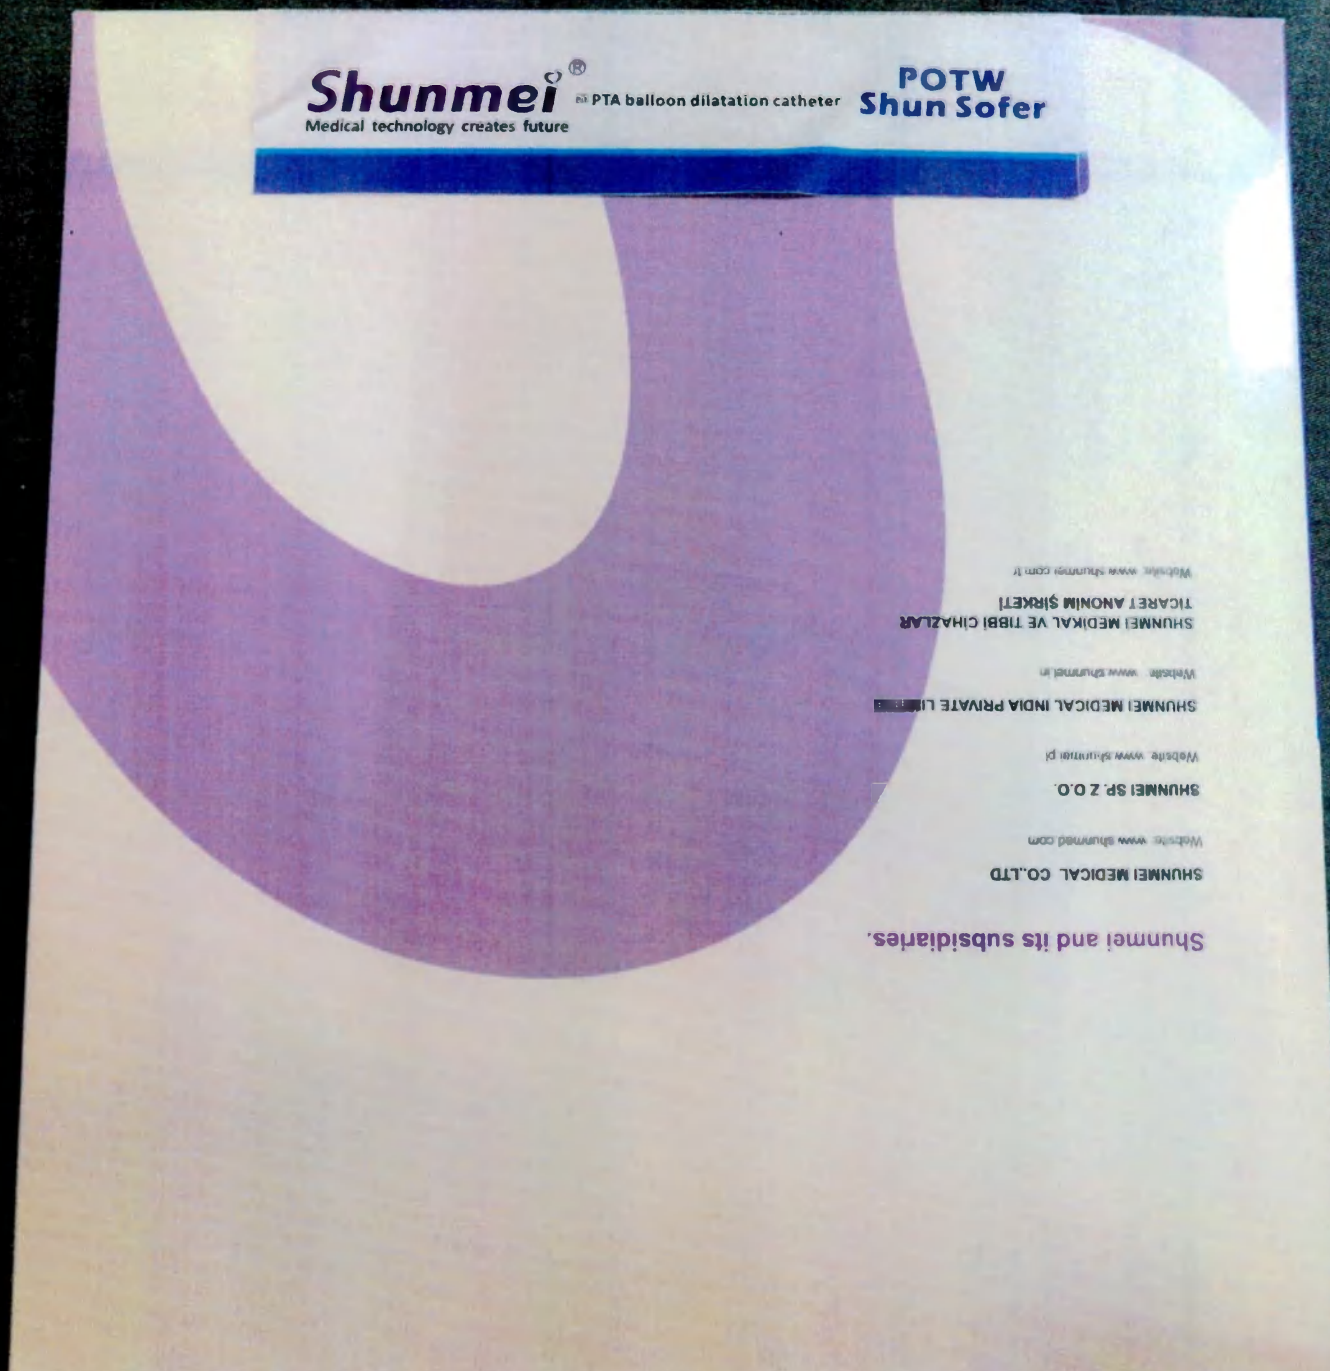


Рис. 17. Пример вторичной упаковки

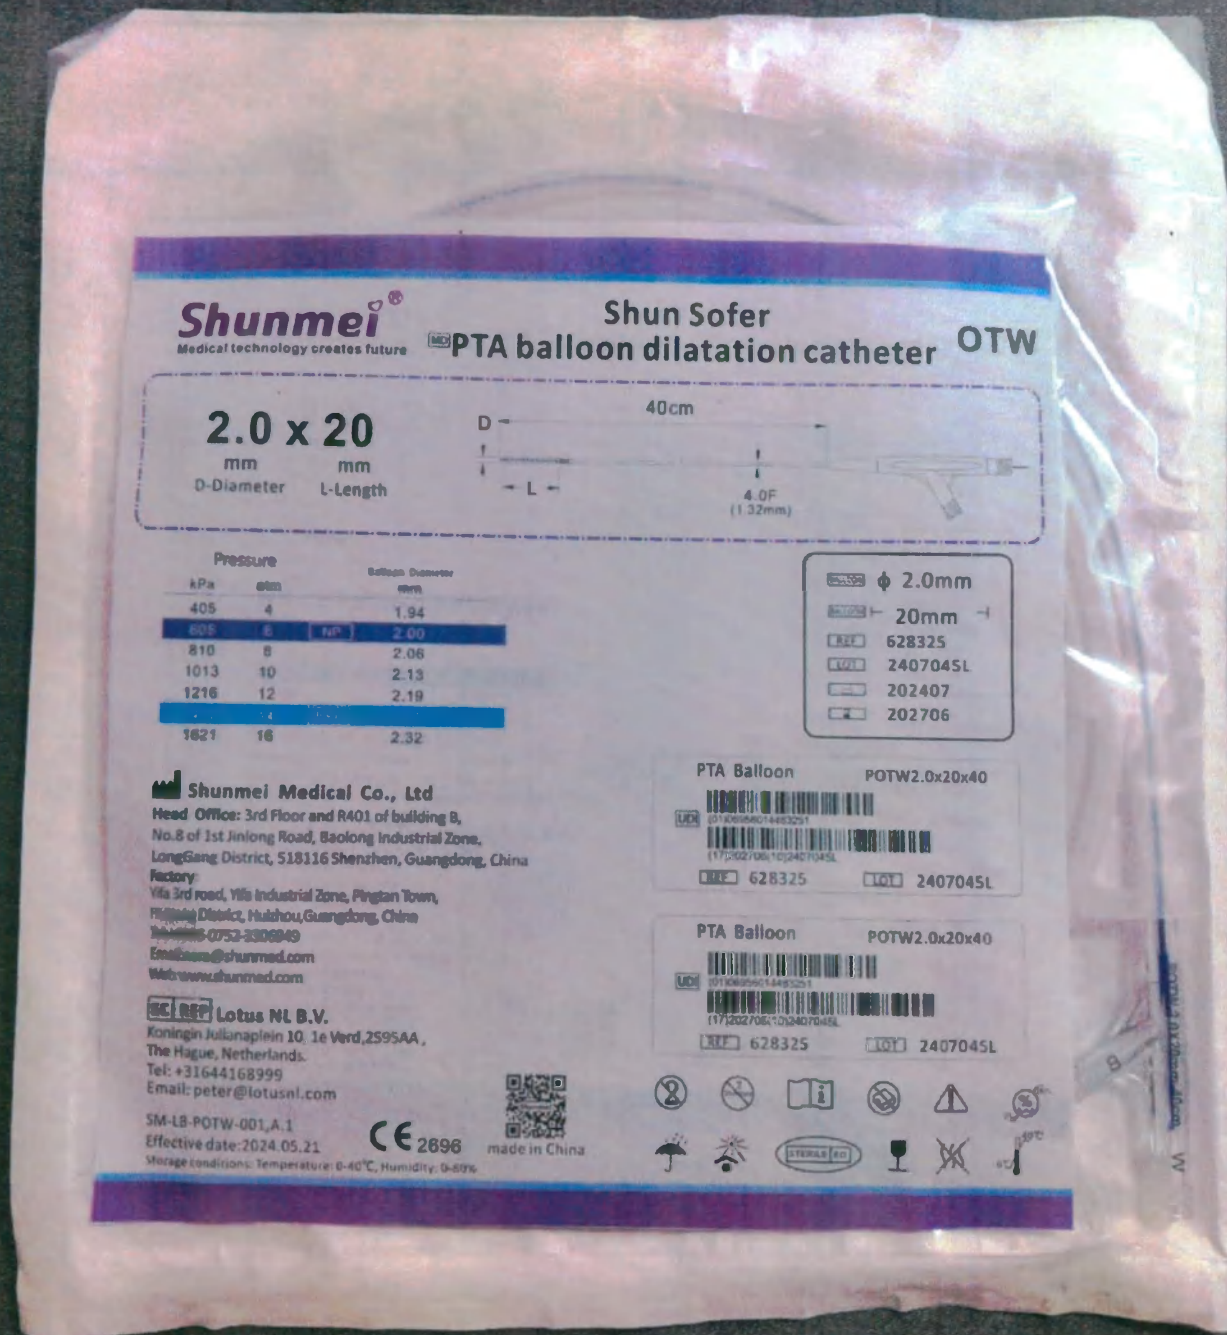



Рис. 18. Пример первичной упаковки

Shunmei[®]
Medical technology creates future

Shun Sofer
PTA balloon dilatation catheter OTW

2.0 x 20

mm mm
D-Diameter L-Length

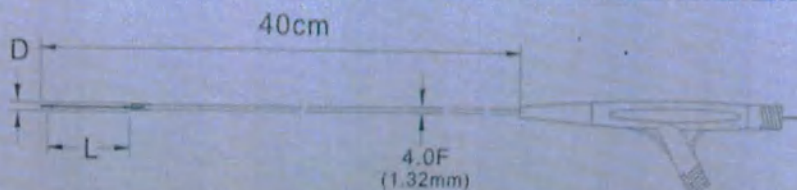

Pressure

kPa atm

Balloon Diameter
mm

405	4		1.94
608	6	NP	2.00
810	8		2.06
1013	10		2.13
1216	12		2.19
1418	14	R&P	2.25
1621	16		2.32

BALLOON ϕ 2.0mm

BALLOON 20mm

REF 628325

LOT 2407045L

EXP 202407

EXP 202706



Shunmei Medical Co., Ltd

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China

Factory:

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +0086-0752-3306949

Email: nora@shunmed.com

Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.

Tel: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com

SM-LB-POTW-001, A.1

Effective date: 2024.05.21

Storage conditions: Temperature: 0-40°C, Humidity: 0-80%

CE 2696


made in China



PTA Balloon

POTW2.0x20x40

UDI



REF 628325

LOT 2407045L

PTA Balloon

POTW2.0x20x40

UDI



REF 628325

LOT 2407045L

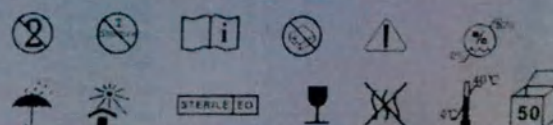



Рис. 19. Пример маркировки транспортной упаковки

Shunmei[®] Shun Sofer OTW

MD PTA balloon dilatation catheter

2.0x20

mm	mm
D-Diameter	L-Length
1.0	1.0
1.5	1.5
2.0	2.0
2.5	2.5
3.0	3.0
3.5	3.5
4.0	4.0
4.5	4.5
5.0	5.0
5.5	5.5
6.0	6.0
6.5	6.5
7.0	7.0
7.5	7.5
8.0	8.0
8.5	8.5
9.0	9.0
9.5	9.5
10.0	10.0
10.5	10.5
11.0	11.0
11.5	11.5
12.0	12.0
12.5	12.5
13.0	13.0
13.5	13.5
14.0	14.0
14.5	14.5
15.0	15.0
15.5	15.5
16.0	16.0
16.5	16.5
17.0	17.0
17.5	17.5
18.0	18.0
18.5	18.5
19.0	19.0
19.5	19.5
20.0	20.0
20.5	20.5
21.0	21.0
21.5	21.5
22.0	22.0
22.5	22.5
23.0	23.0
23.5	23.5
24.0	24.0
24.5	24.5
25.0	25.0
25.5	25.5
26.0	26.0
26.5	26.5
27.0	27.0
27.5	27.5
28.0	28.0
28.5	28.5
29.0	29.0
29.5	29.5
30.0	30.0
30.5	30.5
31.0	31.0
31.5	31.5
32.0	32.0
32.5	32.5
33.0	33.0
33.5	33.5
34.0	34.0
34.5	34.5
35.0	35.0
35.5	35.5
36.0	36.0
36.5	36.5
37.0	37.0
37.5	37.5
38.0	38.0
38.5	38.5
39.0	39.0
39.5	39.5
40.0	40.0
40.5	40.5
41.0	41.0
41.5	41.5
42.0	42.0
42.5	42.5
43.0	43.0
43.5	43.5
44.0	44.0
44.5	44.5
45.0	45.0
45.5	45.5
46.0	46.0
46.5	46.5
47.0	47.0
47.5	47.5
48.0	48.0
48.5	48.5
49.0	49.0
49.5	49.5
50.0	50.0
50.5	50.5
51.0	51.0
51.5	51.5
52.0	52.0
52.5	52.5
53.0	53.0
53.5	53.5
54.0	54.0
54.5	54.5
55.0	55.0
55.5	55.5
56.0	56.0
56.5	56.5
57.0	57.0
57.5	57.5
58.0	58.0
58.5	58.5
59.0	59.0
59.5	59.5
60.0	60.0
60.5	60.5
61.0	61.0
61.5	61.5
62.0	62.0
62.5	62.5
63.0	63.0
63.5	63.5
64.0	64.0
64.5	64.5
65.0	65.0
65.5	65.5
66.0	66.0
66.5	66.5
67.0	67.0
67.5	67.5
68.0	68.0
68.5	68.5
69.0	69.0
69.5	69.5
70.0	70.0
70.5	70.5
71.0	71.0
71.5	71.5
72.0	72.0
72.5	72.5
73.0	73.0
73.5	73.5
74.0	74.0
74.5	74.5
75.0	75.0
75.5	75.5
76.0	76.0

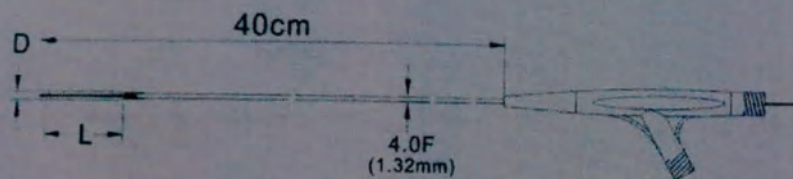

BALLOON ϕ 2.0mm

BALLOON 1- 20mm -

REF 628325

LOT 2407045L

202407

202706

Pressure		Ballon Diameter (mm)
ATM	KPa	
4	405	1.94
6(RBP)	588	2.25
8	810	2.06
10	1013	2.13
12	1216	2.19
14(RBP)	1418	2.25
16	1621	2.32

Do not exceed the rated burst pressure (RBP).

POTW 2.0 x 20
Shun Sofer mm mm

 Shunmei Medical Co., Ltd

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory:

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +0086-0752-3306949

Email: nora@shunmed.com

Web: www.shunmed.com

EC REP. ...

EC REP Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.

Tel: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com
made in China

made in China

SM-LB-POTW-001,A.1
Effective date:2024.05.21

Storage conditions: Temperature:

0-40°C, Humidity: 0-80%

PTA balloon dilatation catheter

CE
2696

PTA Balloon

POTW2.0x20x40



REF 628325

LOY 2407045L

PTA Balloon

POTW2.0x20x40



REF 628325

JOY 2407045L




Рис. 20. Пример маркировки вторичной упаковки

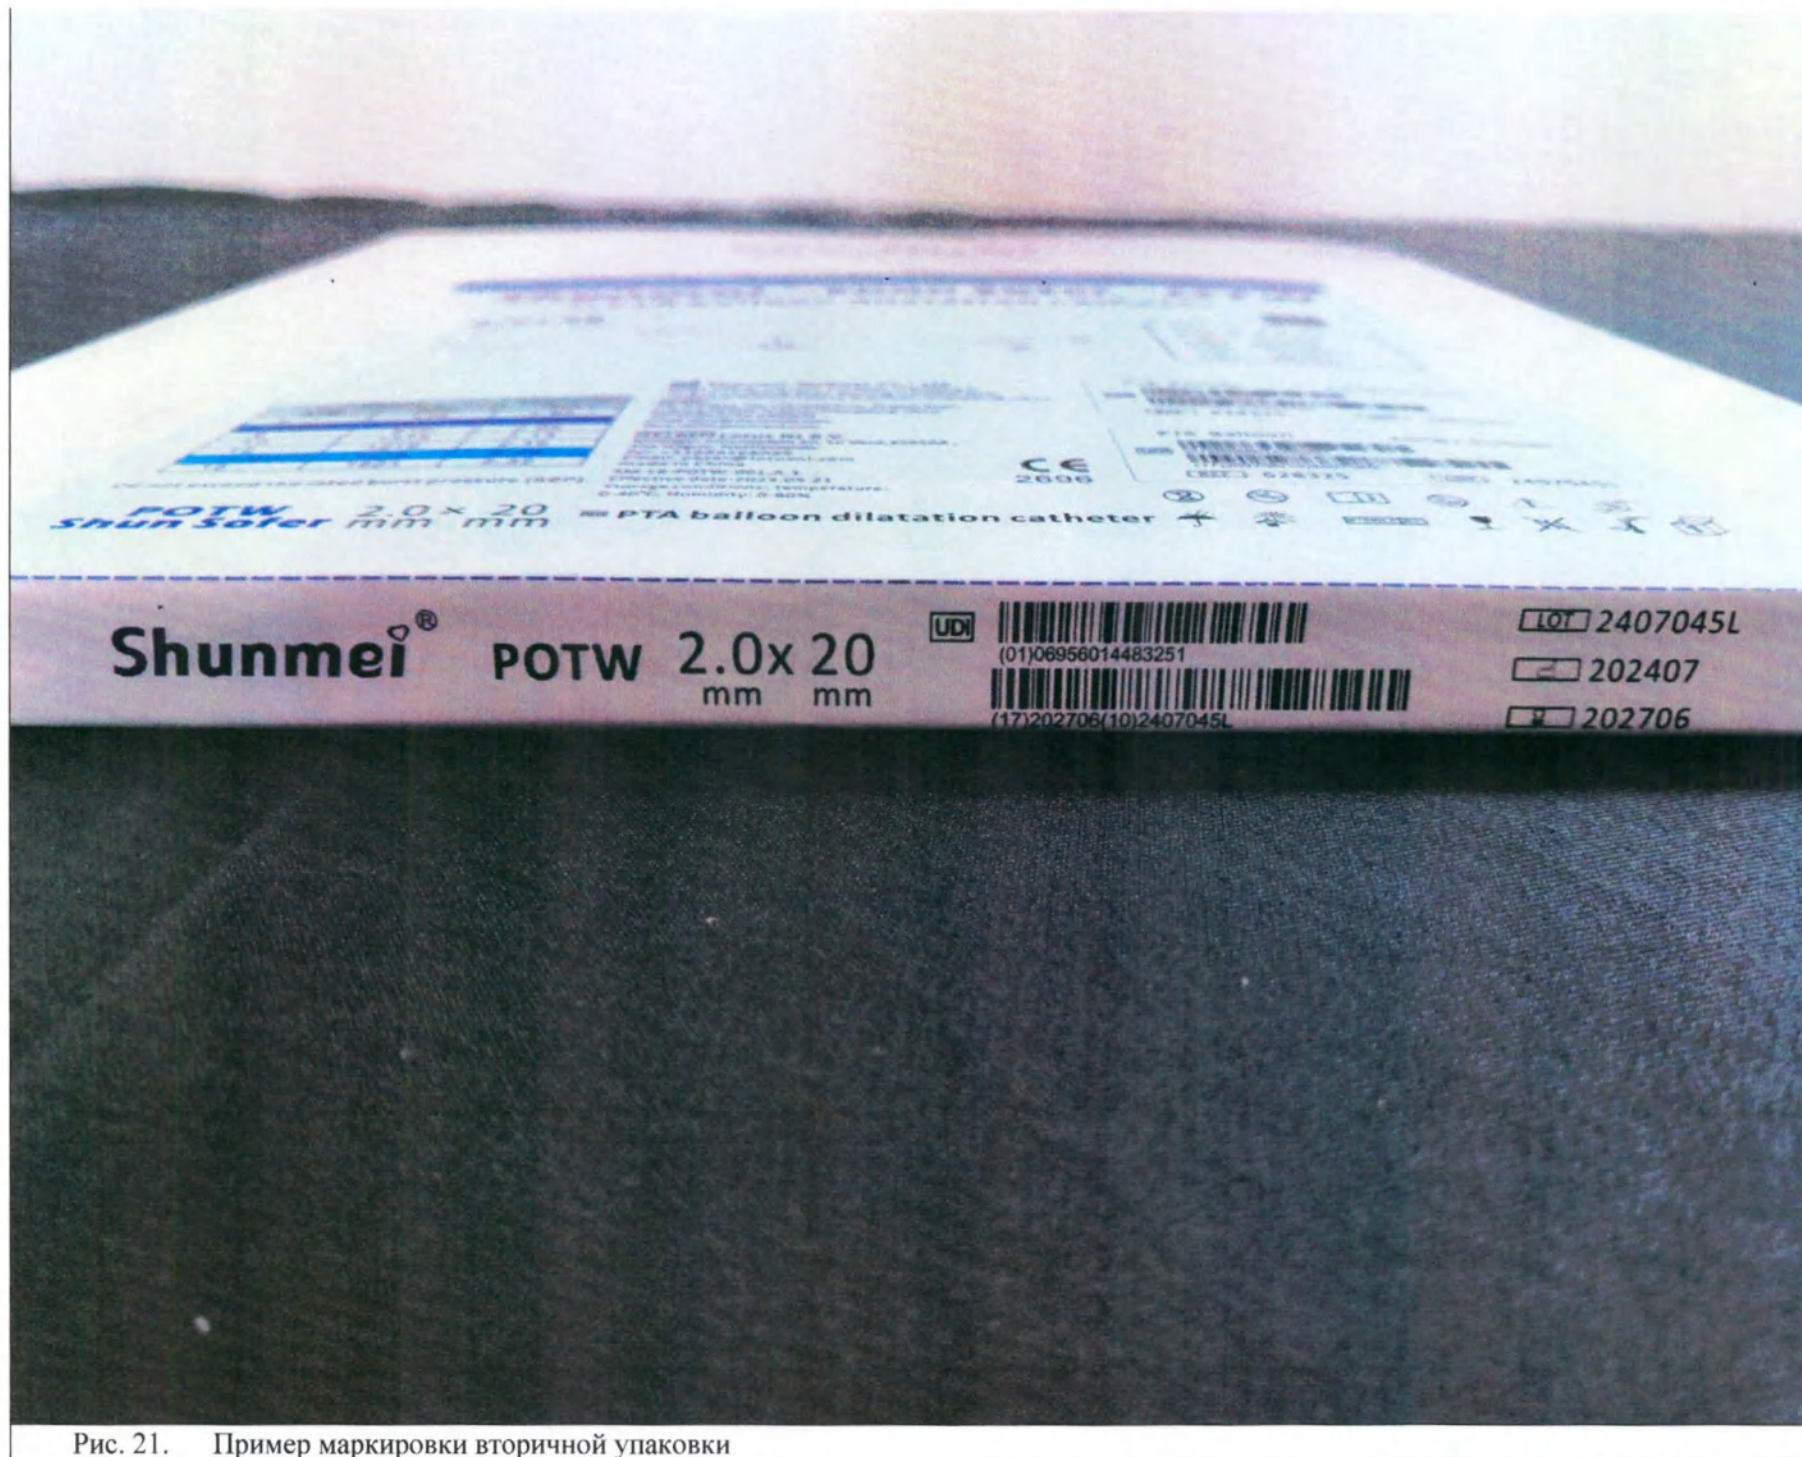



Рис. 21. Пример маркировки вторичной упаковки

Shunmei[®]
Medical technology creates future

Shun Sofer
PTA balloon dilatation catheter OTW

2.0 x 20

mm	mm
D-Diameter	L-Length
1.0	1.0
1.5	1.5
2.0	2.0
2.5	2.5
3.0	3.0
3.5	3.5
4.0	4.0
4.5	4.5
5.0	5.0
5.5	5.5
6.0	6.0
6.5	6.5
7.0	7.0
7.5	7.5
8.0	8.0
8.5	8.5
9.0	9.0
9.5	9.5
10.0	10.0
10.5	10.5
11.0	11.0
11.5	11.5
12.0	12.0
12.5	12.5
13.0	13.0
13.5	13.5
14.0	14.0
14.5	14.5
15.0	15.0
15.5	15.5
16.0	16.0
16.5	16.5
17.0	17.0
17.5	17.5
18.0	18.0
18.5	18.5
19.0	19.0
19.5	19.5
20.0	20.0
20.5	20.5
21.0	21.0
21.5	21.5
22.0	22.0
22.5	22.5
23.0	23.0
23.5	23.5
24.0	24.0
24.5	24.5
25.0	25.0
25.5	25.5
26.0	26.0
26.5	26.5
27.0	27.0
27.5	27.5
28.0	28.0
28.5	28.5
29.0	29.0
29.5	29.5
30.0	30.0
30.5	30.5
31.0	31.0
31.5	31.5
32.0	32.0
32.5	32.5
33.0	33.0
33.5	33.5
34.0	34.0
34.5	34.5
35.0	35.0
35.5	35.5
36.0	36.0
36.5	36.5
37.0	37.0
37.5	37.5
38.0	38.0
38.5	38.5
39.0	39.0
39.5	39.5
40.0	40.0
40.5	40.5
41.0	41.0
41.5	41.5
42.0	42.0
42.5	42.5
43.0	43.0
43.5	43.5
44.0	44.0
44.5	44.5
45.0	45.0
45.5	45.5
46.0	46.0
46.5	46.5
47.0	47.0
47.5	47.5
48.0	48.0
48.5	48.5
49.0	49.0
49.5	49.5
50.0	50.0
50.5	50.5
51.0	51.0
51.5	51.5
52.0	52.0
52.5	52.5
53.0	53.0
53.5	53.5
54.0	54.0
54.5	54.5
55.0	55.0
55.5	55.5
56.0	56.0
56.5	56.5
57.0	57.0
57.5	57.5
58.0	58.0
58.5	58.5
59.0	59.0
59.5	59.5
60.0	60.0
60.5	60.5
61.0	61.0
61.5	61.5
62.0	62.0
62.5	62.5
63.0	63.0
63.5	63.5
64.0	64.0
64.5	64.5
65.0	65.0
65.5	65.5
66.0	66.0
66.5	66.5
67.0	67.0
67.5	67.5
68.0	68.0
68.5	68.5
69.0	69.0
69.5	69.5
70.0	70.0
70.5	70.5
71.0	71.0
71.5	71.5
72.0	72.0
72.5	72.5
73.0	73.0
73.5	73.5
74.0	74.0
74.5	74.5
75.0	75.0
75.5	75.5
76.0	76.0

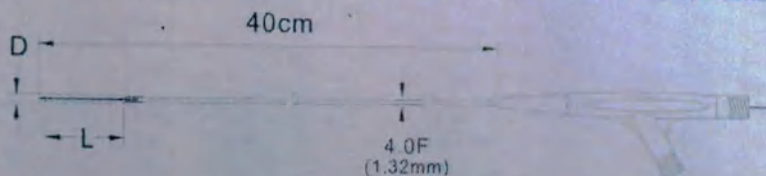

Pressure		Balloon Diameter
kPa	atm	mm
405	4	1.94
608	6	2.00
810	8	2.06
1013	10	2.13
1216	12	2.19
1418	14	2.25
1621	16	2.32

Ø 2.0mm

BALLOON $\pm$ 20mm $\pm$

REF 628325

LOT 2407045L

202407

202706

 Shunmei Medical Co., Ltd

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China

Factory:
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com

SM-LB-POTW-001,A.1

Effective date:2024.05.21

Storage conditions: Temperature: 0-40°C, Humidity: 0-80%

PTA Balloon POTW2.0x20x40



REF 628325 LOT 2407045L

PTA Balloon	PQW2.0x20x40
-------------	--------------



REF 628325 LOT 2407045L



CE 2696

made in China



Part 2.0X20mm-40cm

Рис. 22. Пример маркировки первичной упаковки

**Катетер баллонный дилатационный ПТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики
в вариантах исполнения**

РУ и дата Регистрационного удостоверения

1. Катетер баллонный дилатационный ПТА Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики Shun Sofer, размер баллона XXX x XXX мм, эффективная длина XXX см – 1 шт.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмей Медикал Ко., Лтд, КНР)

Юридический адрес производителя:

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116
Shenzhen, Guangdong, China.

Место производства медицинского изделия:

Shunmei Medical Co., Ltd

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Серия (☐): см. на упаковке

Номер по каталогу (☐): см. на упаковке

Использовать до (☐): см. на упаковке

Способ применения: См. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов: см. в инструкции по применению.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЦИСЗ», 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232;

Электронный адрес: office@hscmail.pro

Телефон: +7 (495) 798-01-60

Сделано в Китае

Рис. 23. Макет русскоязычной маркировки

Всего прошито, пронумеровано,
(23) листов

Генеральный директор

ООО «ЦИМЗ»

Шишов К.Г.

