

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Лидер по регистрации

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

Ю.Н. Дорофеева

2023 г.



## **Фотографические изображения**

**«Система рентгеновская AMX Navigate с принадлежностями»**

**Производства:**

**«ДжиИ Медикал Системз, Эл-Эл-Си», США (GE Medical Systems, LLC)**



Рис. 1. Система рентгеновская AMX Navigate с принадлежностями. Транспортная упаковка



Рис. 2. Система рентгеновская AMX Navigate с принадлежностями. Транспортная упаковка

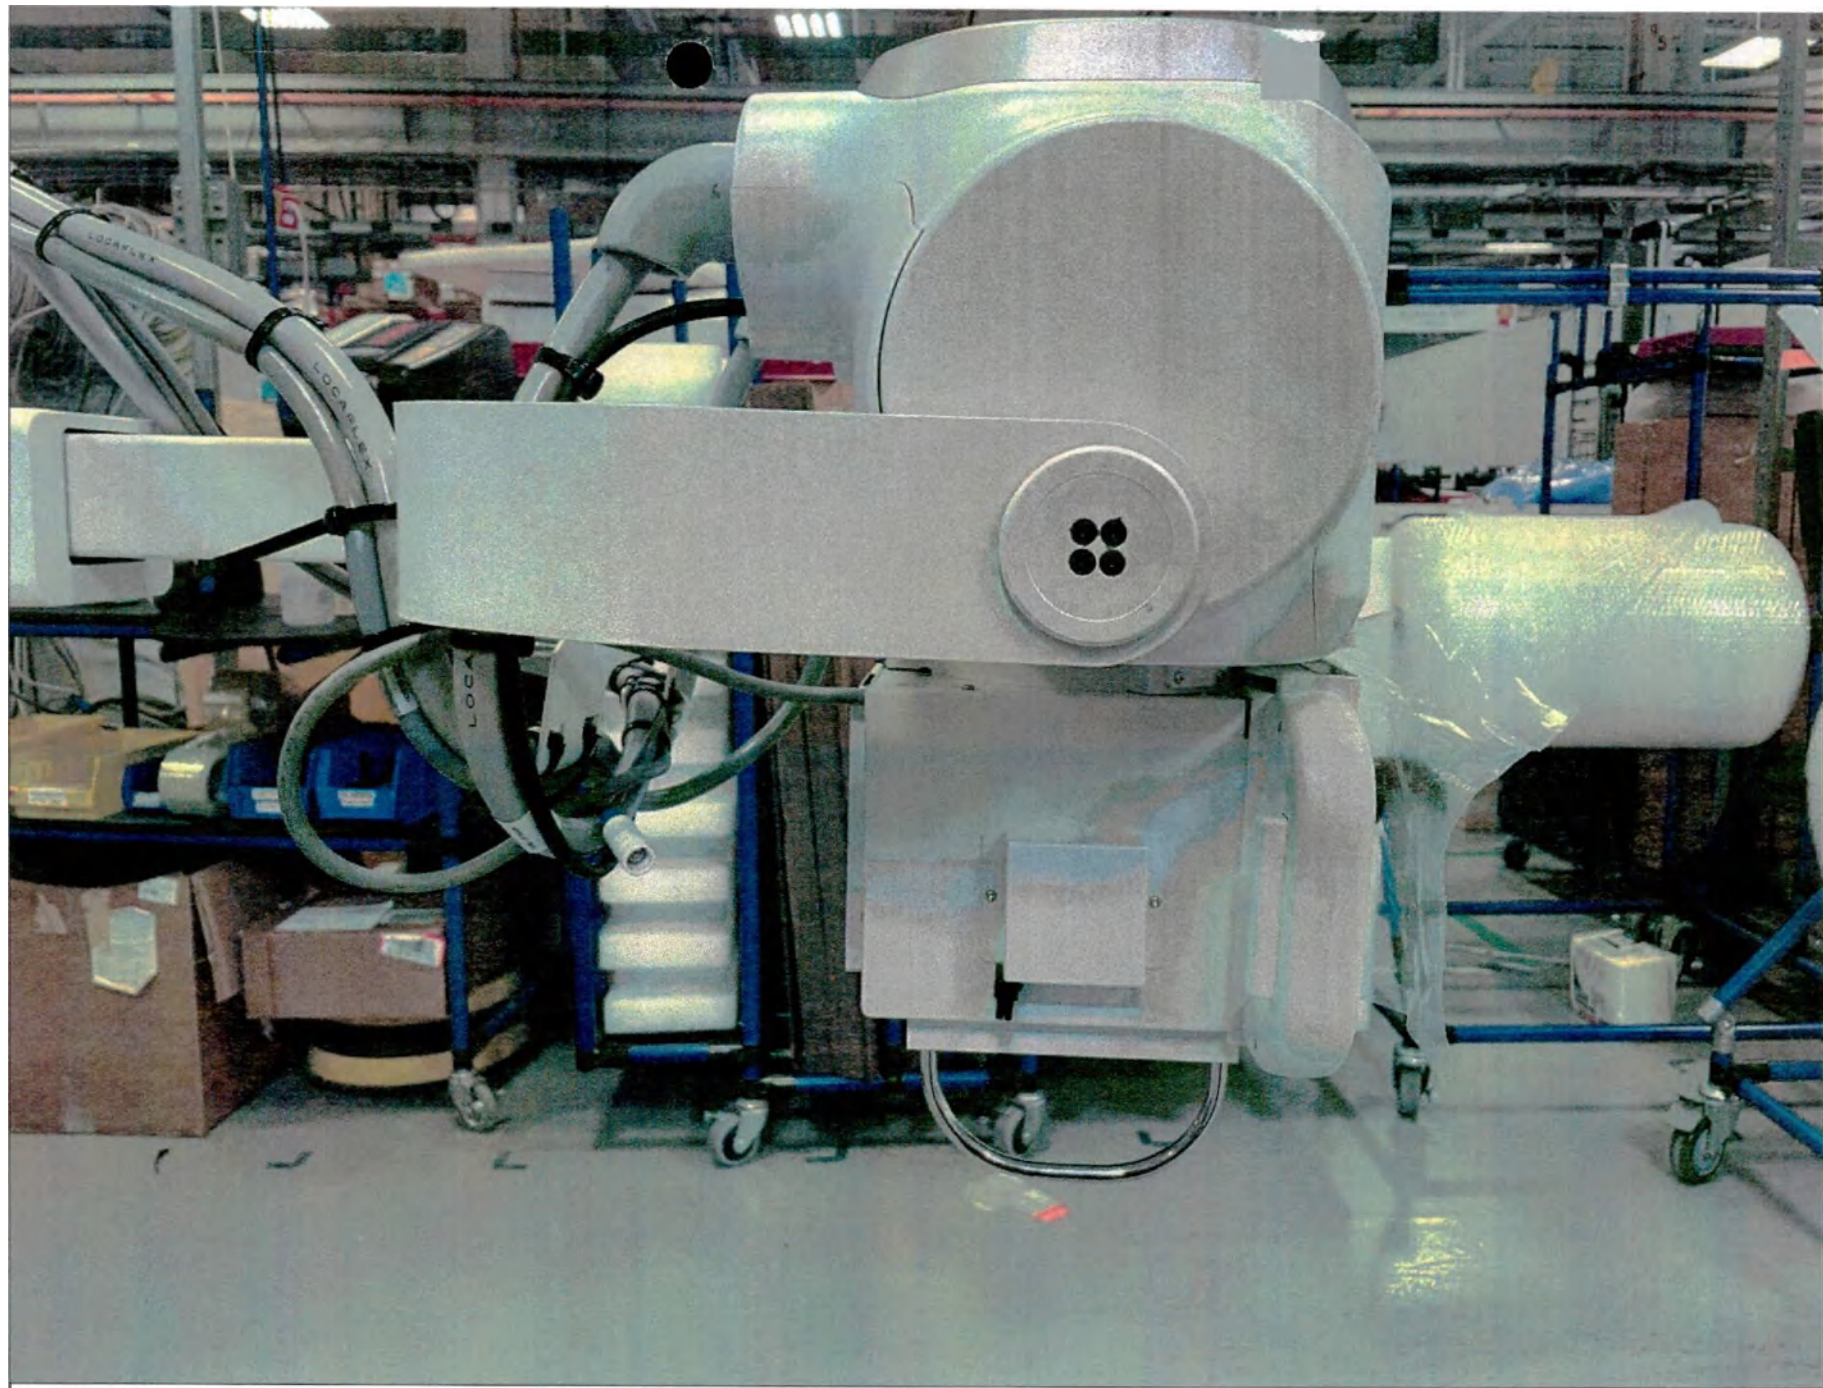
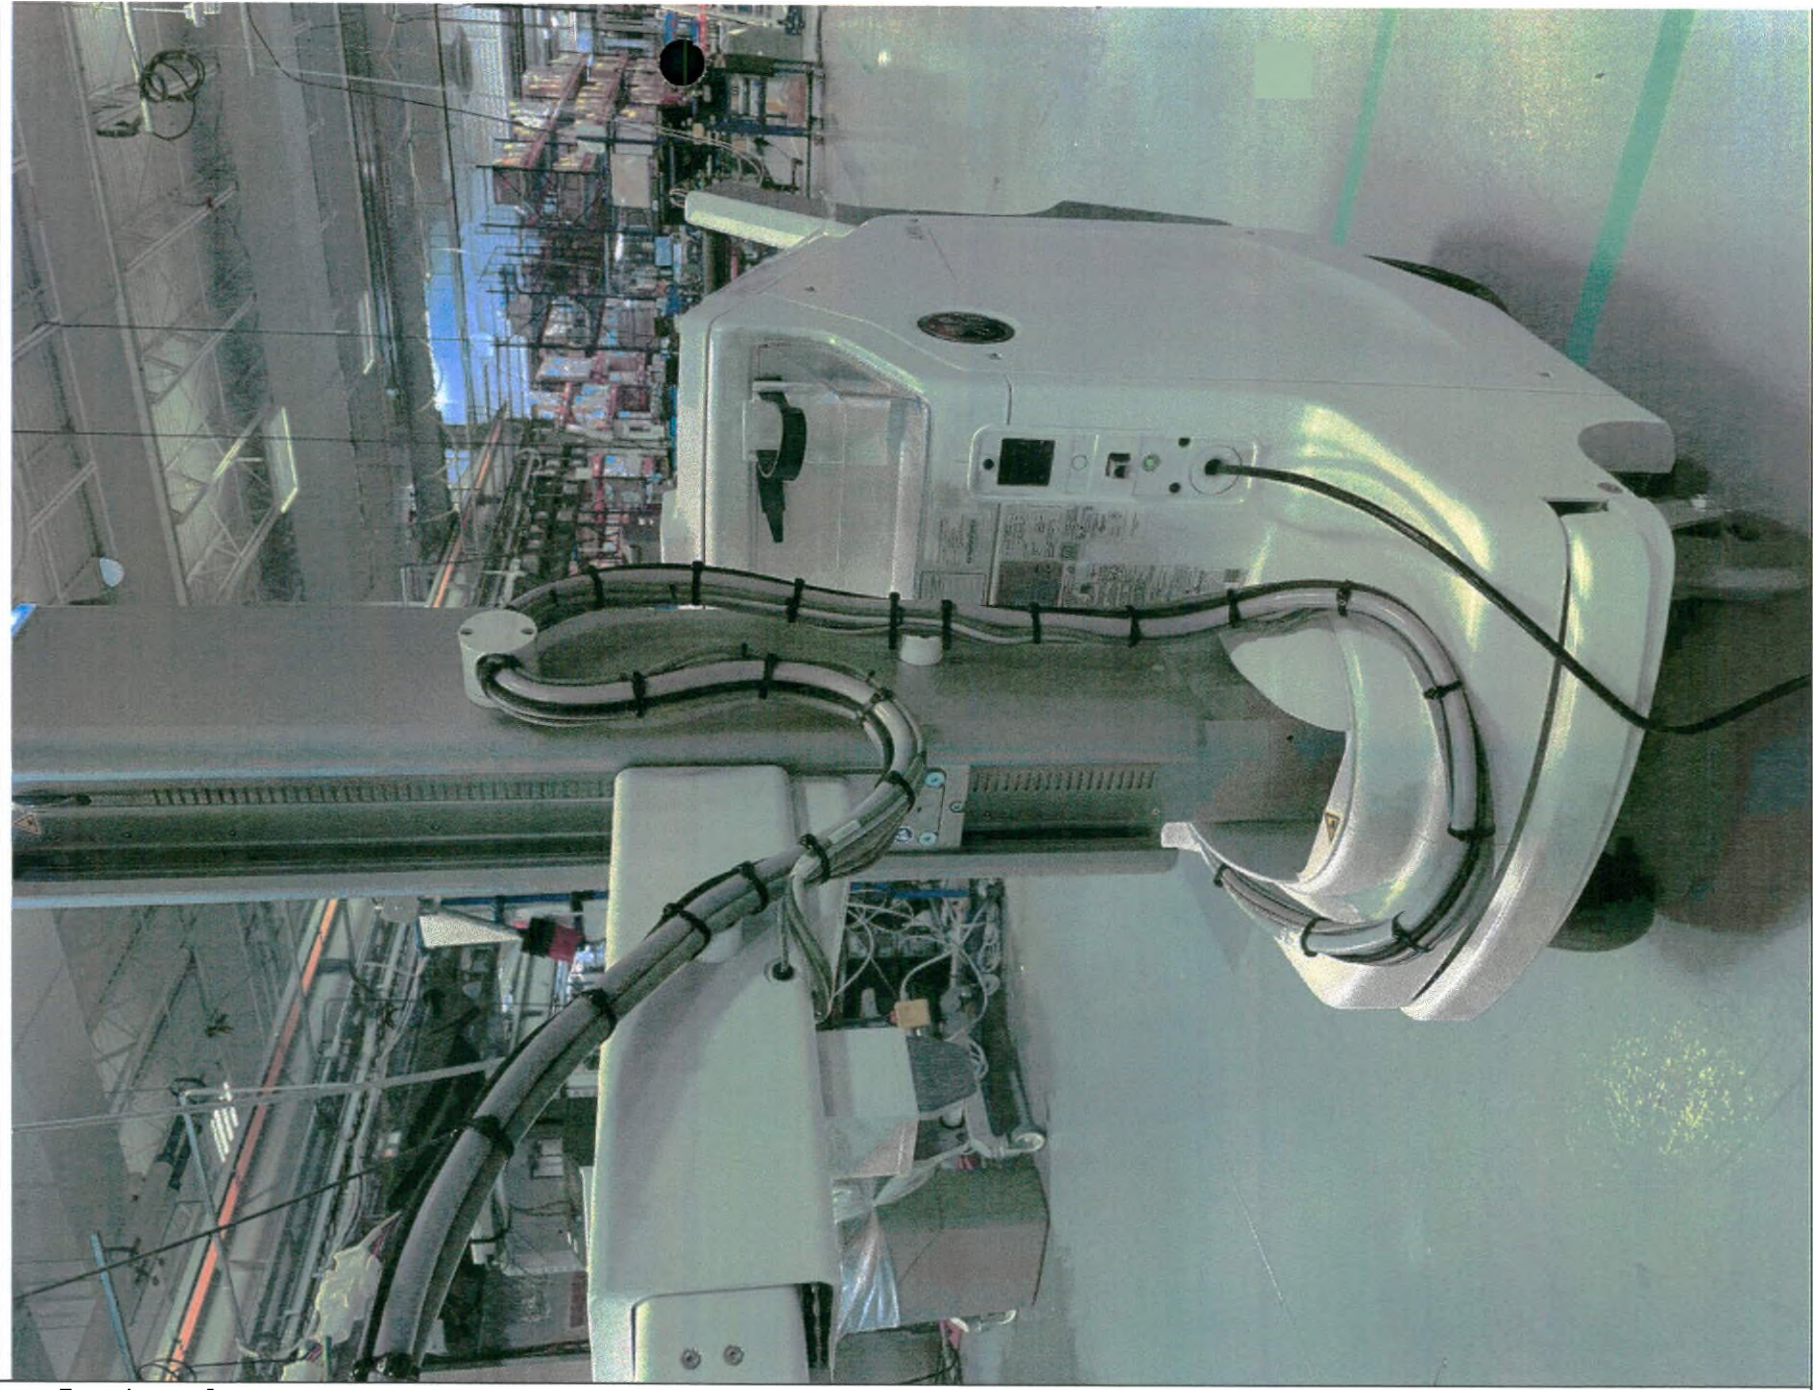


Рис. 3. Система рентгеновская AMX Navigate с принадлежностями.



**Рис. 4. Система рентгеновая AMX Navigate с принадлежностями.**

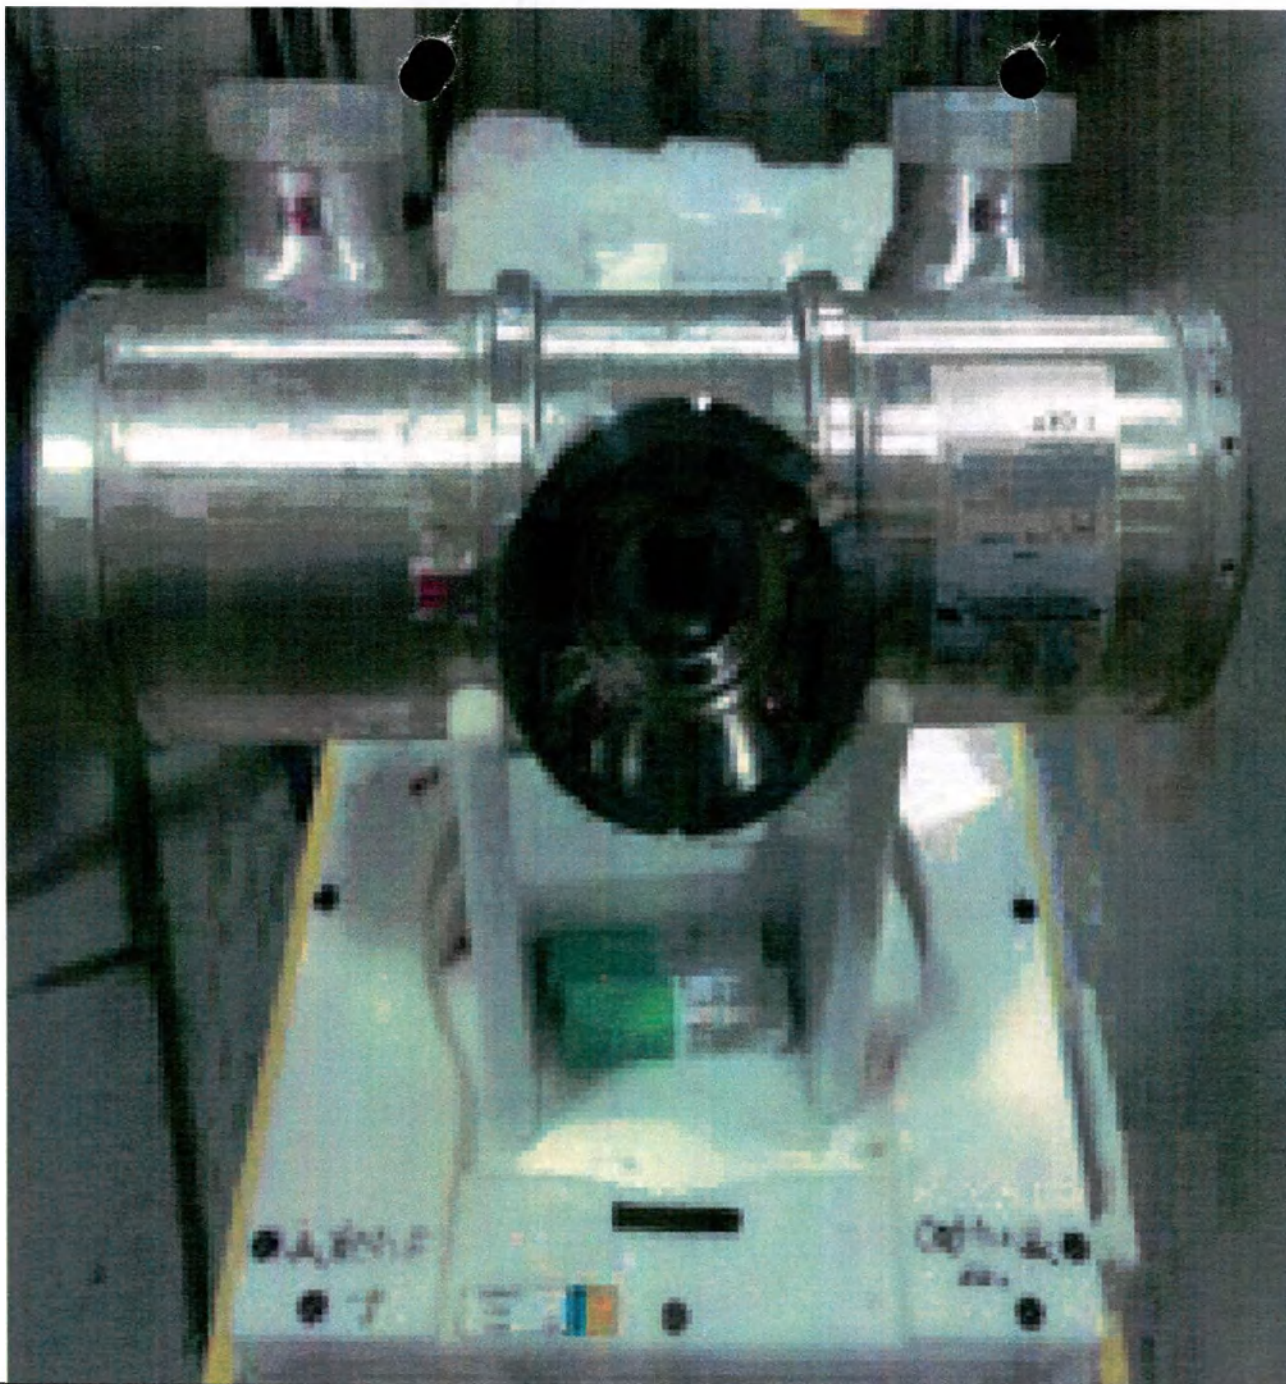


Рис. 5. Трубка рентгеновская



**Рис. 6. Коллиматор**

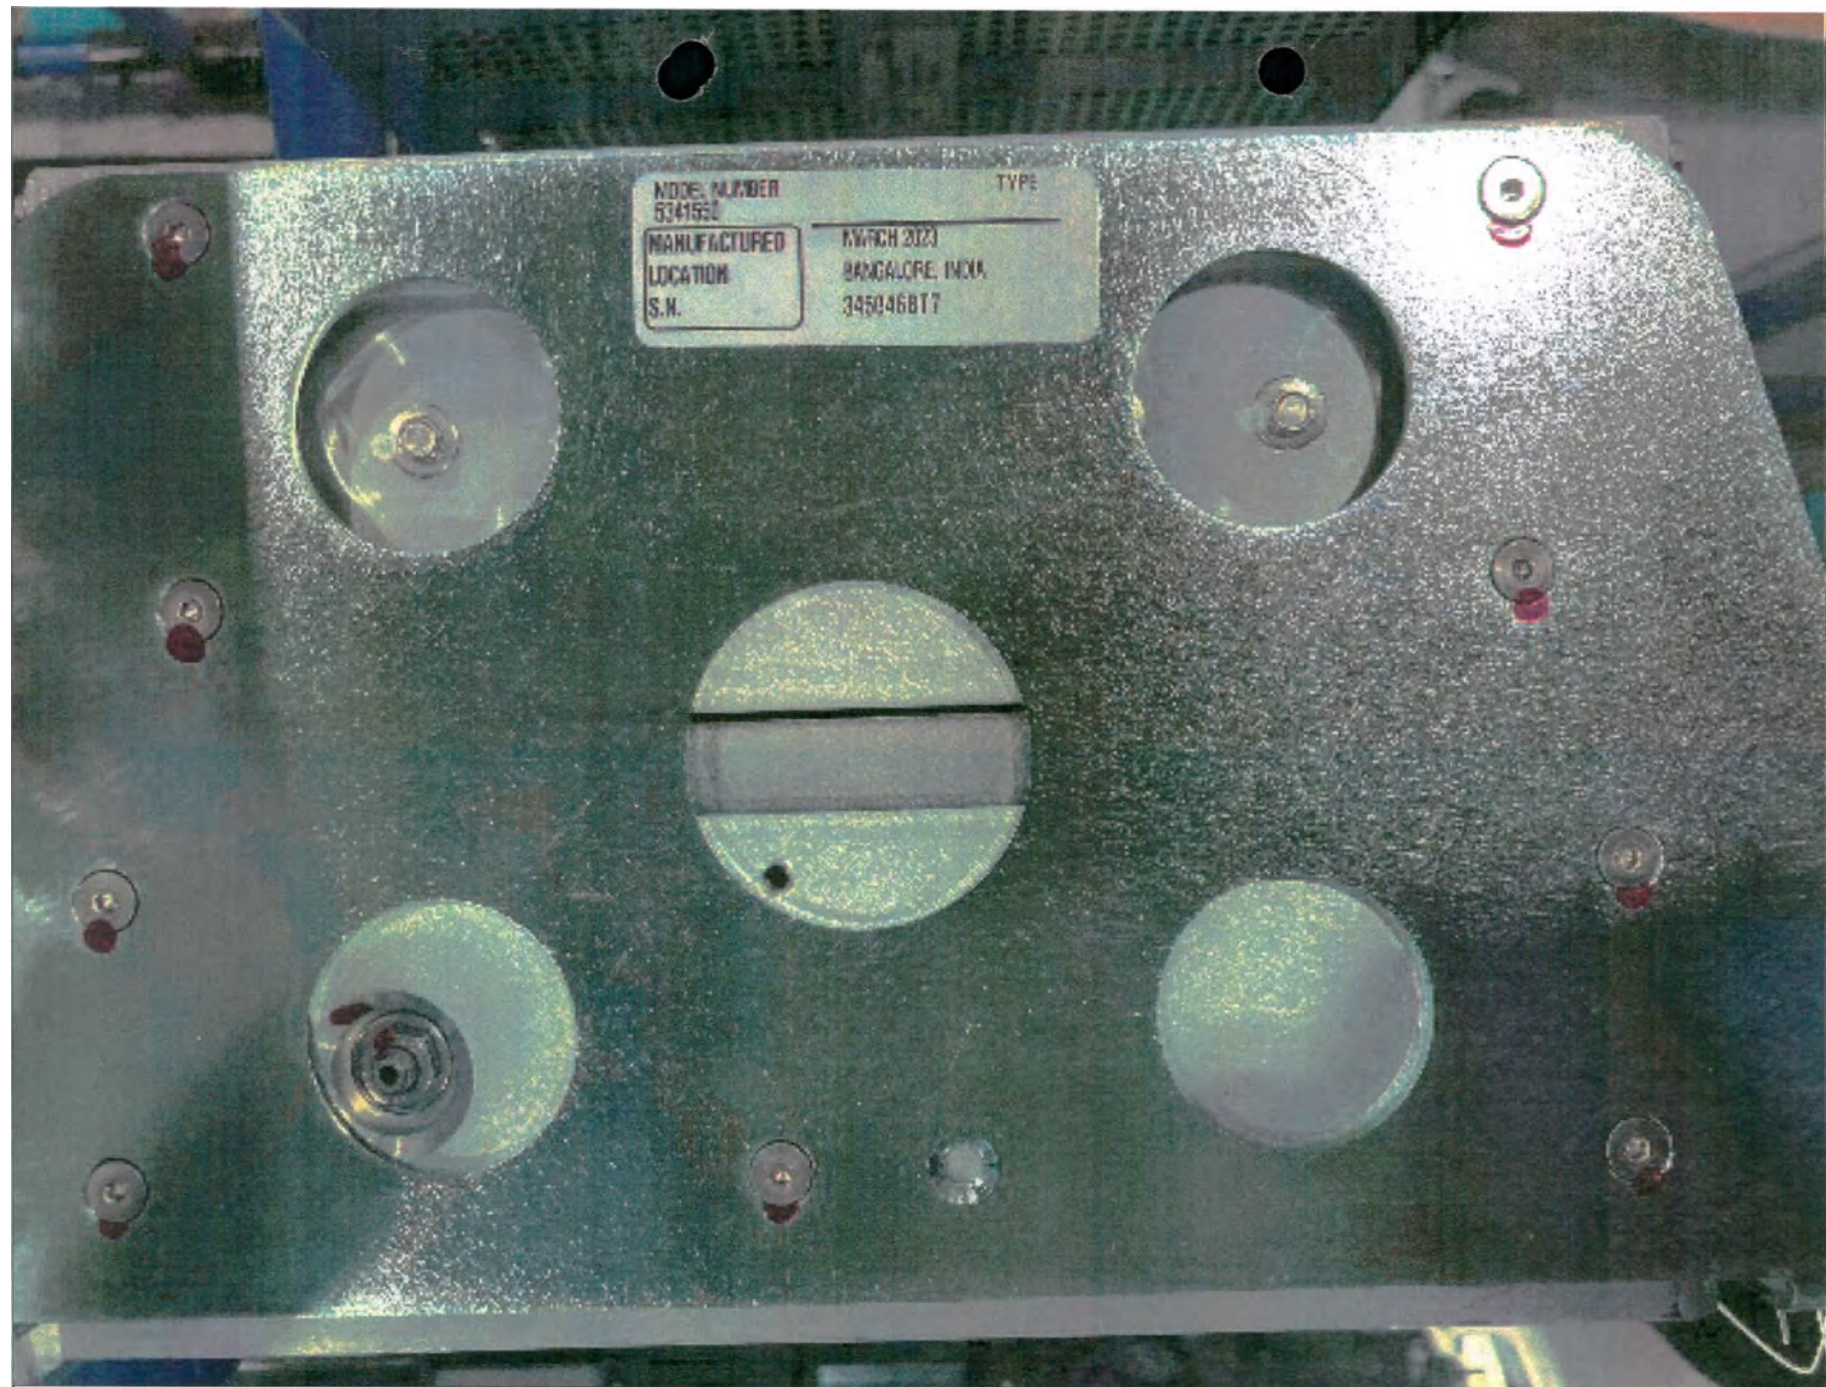


Рис. 7. Высоковольтный генератор

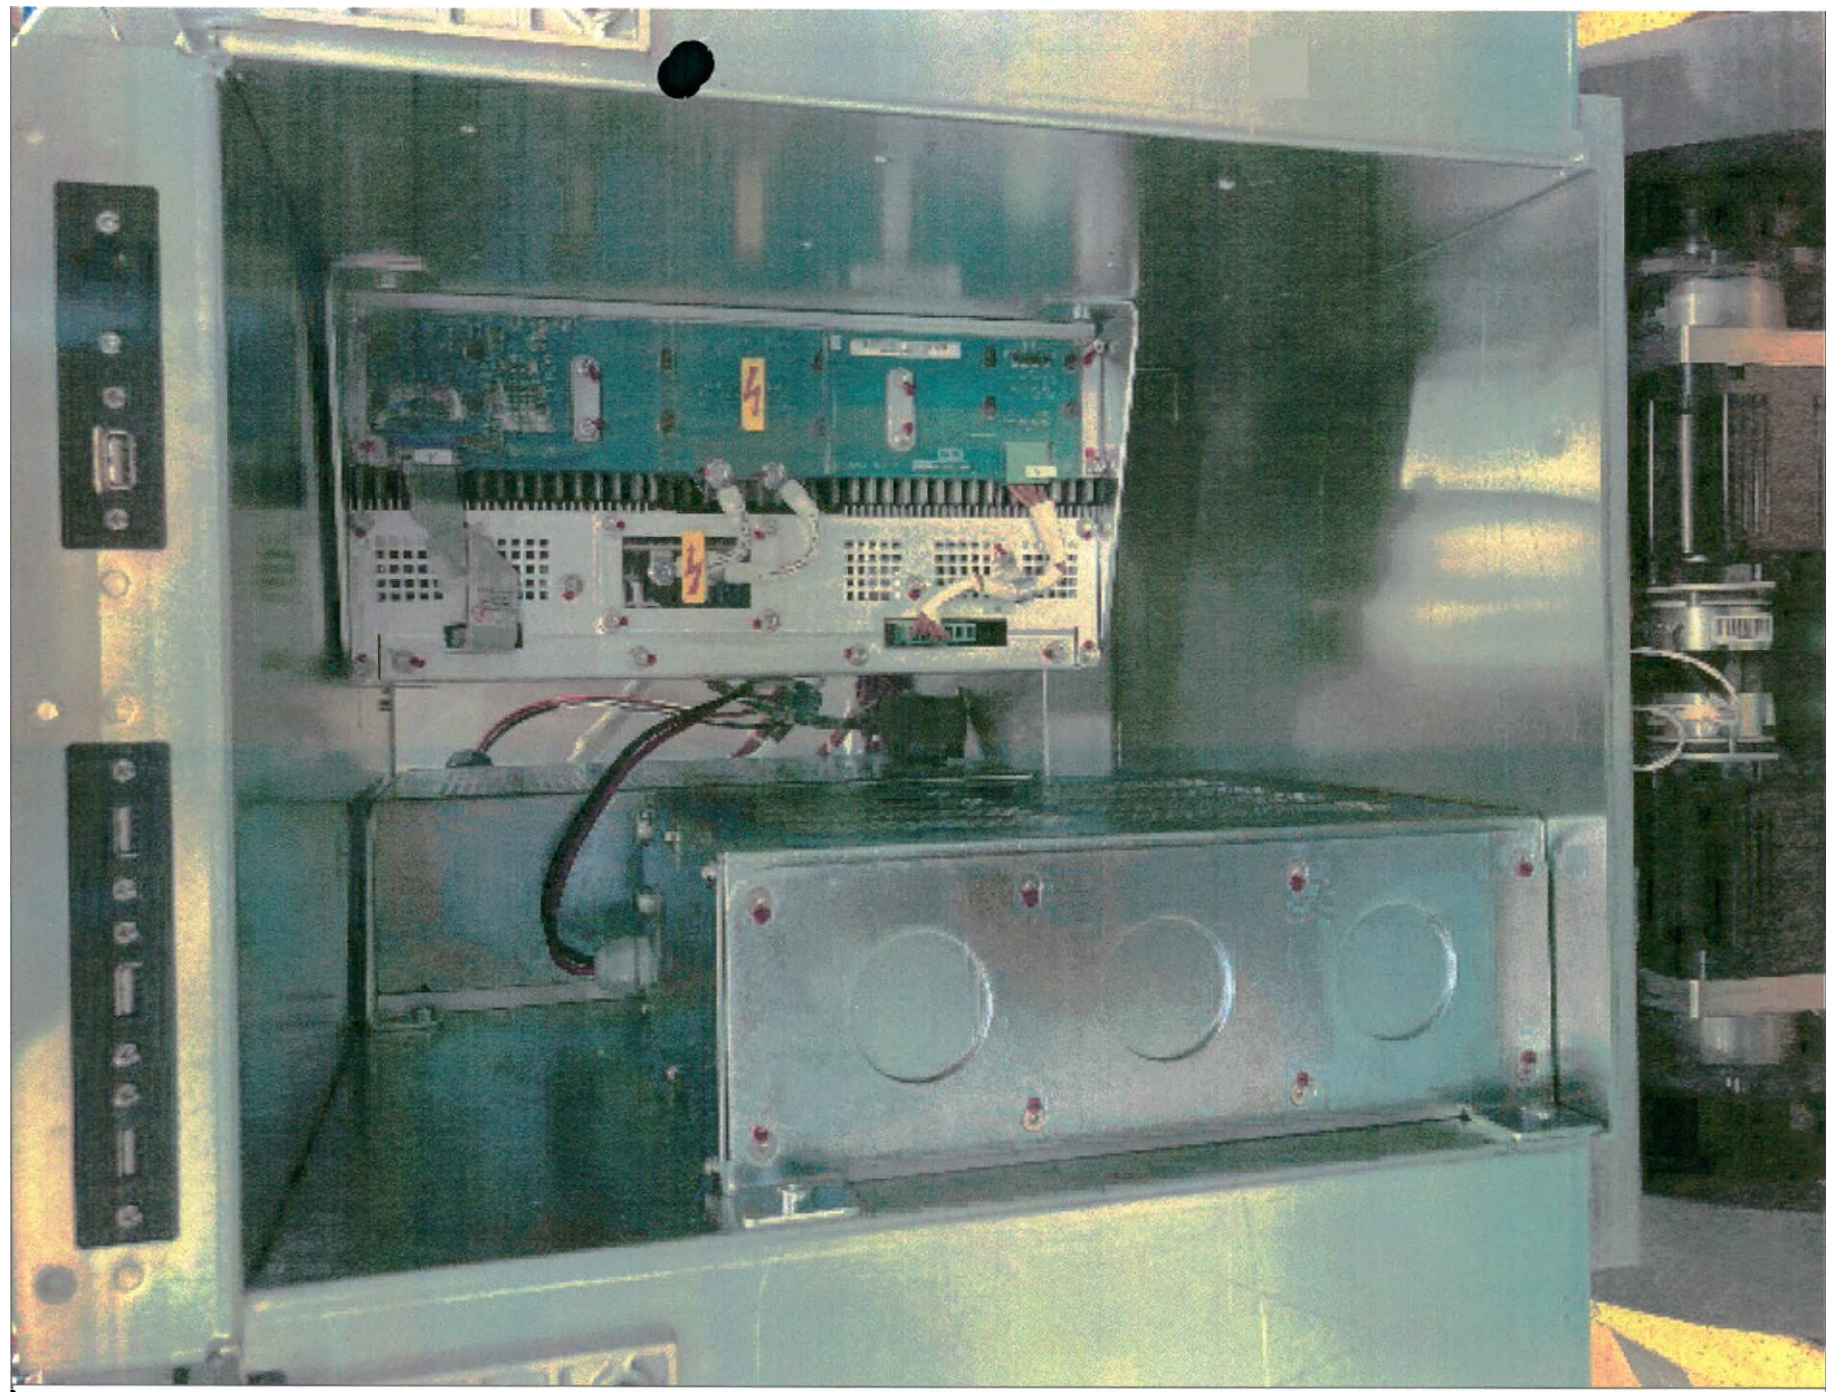


Рис. 8. Высоковольтный генератор

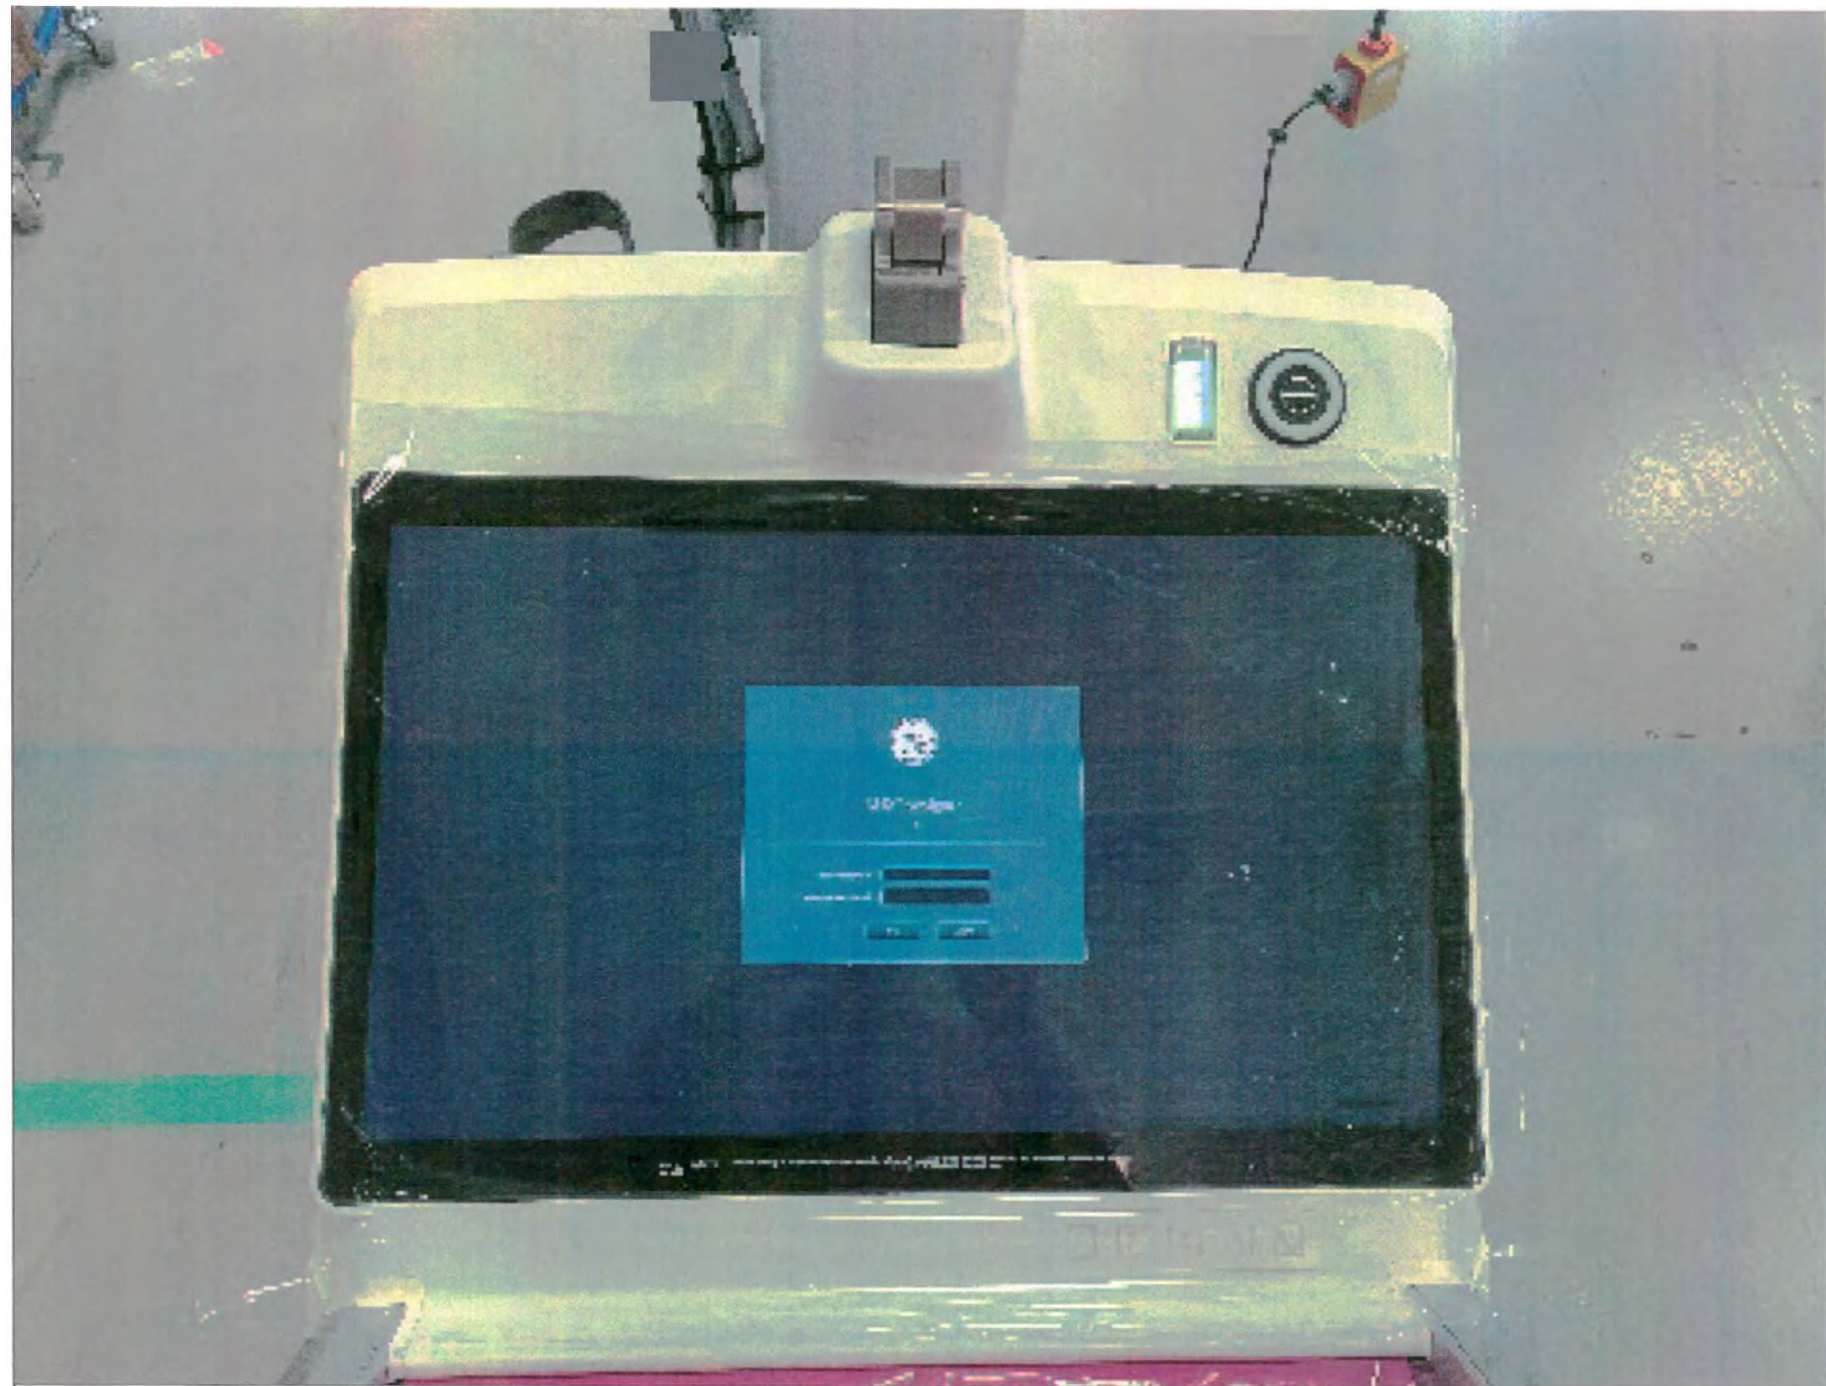


Рис. 9. Панель управления и просмотра данных

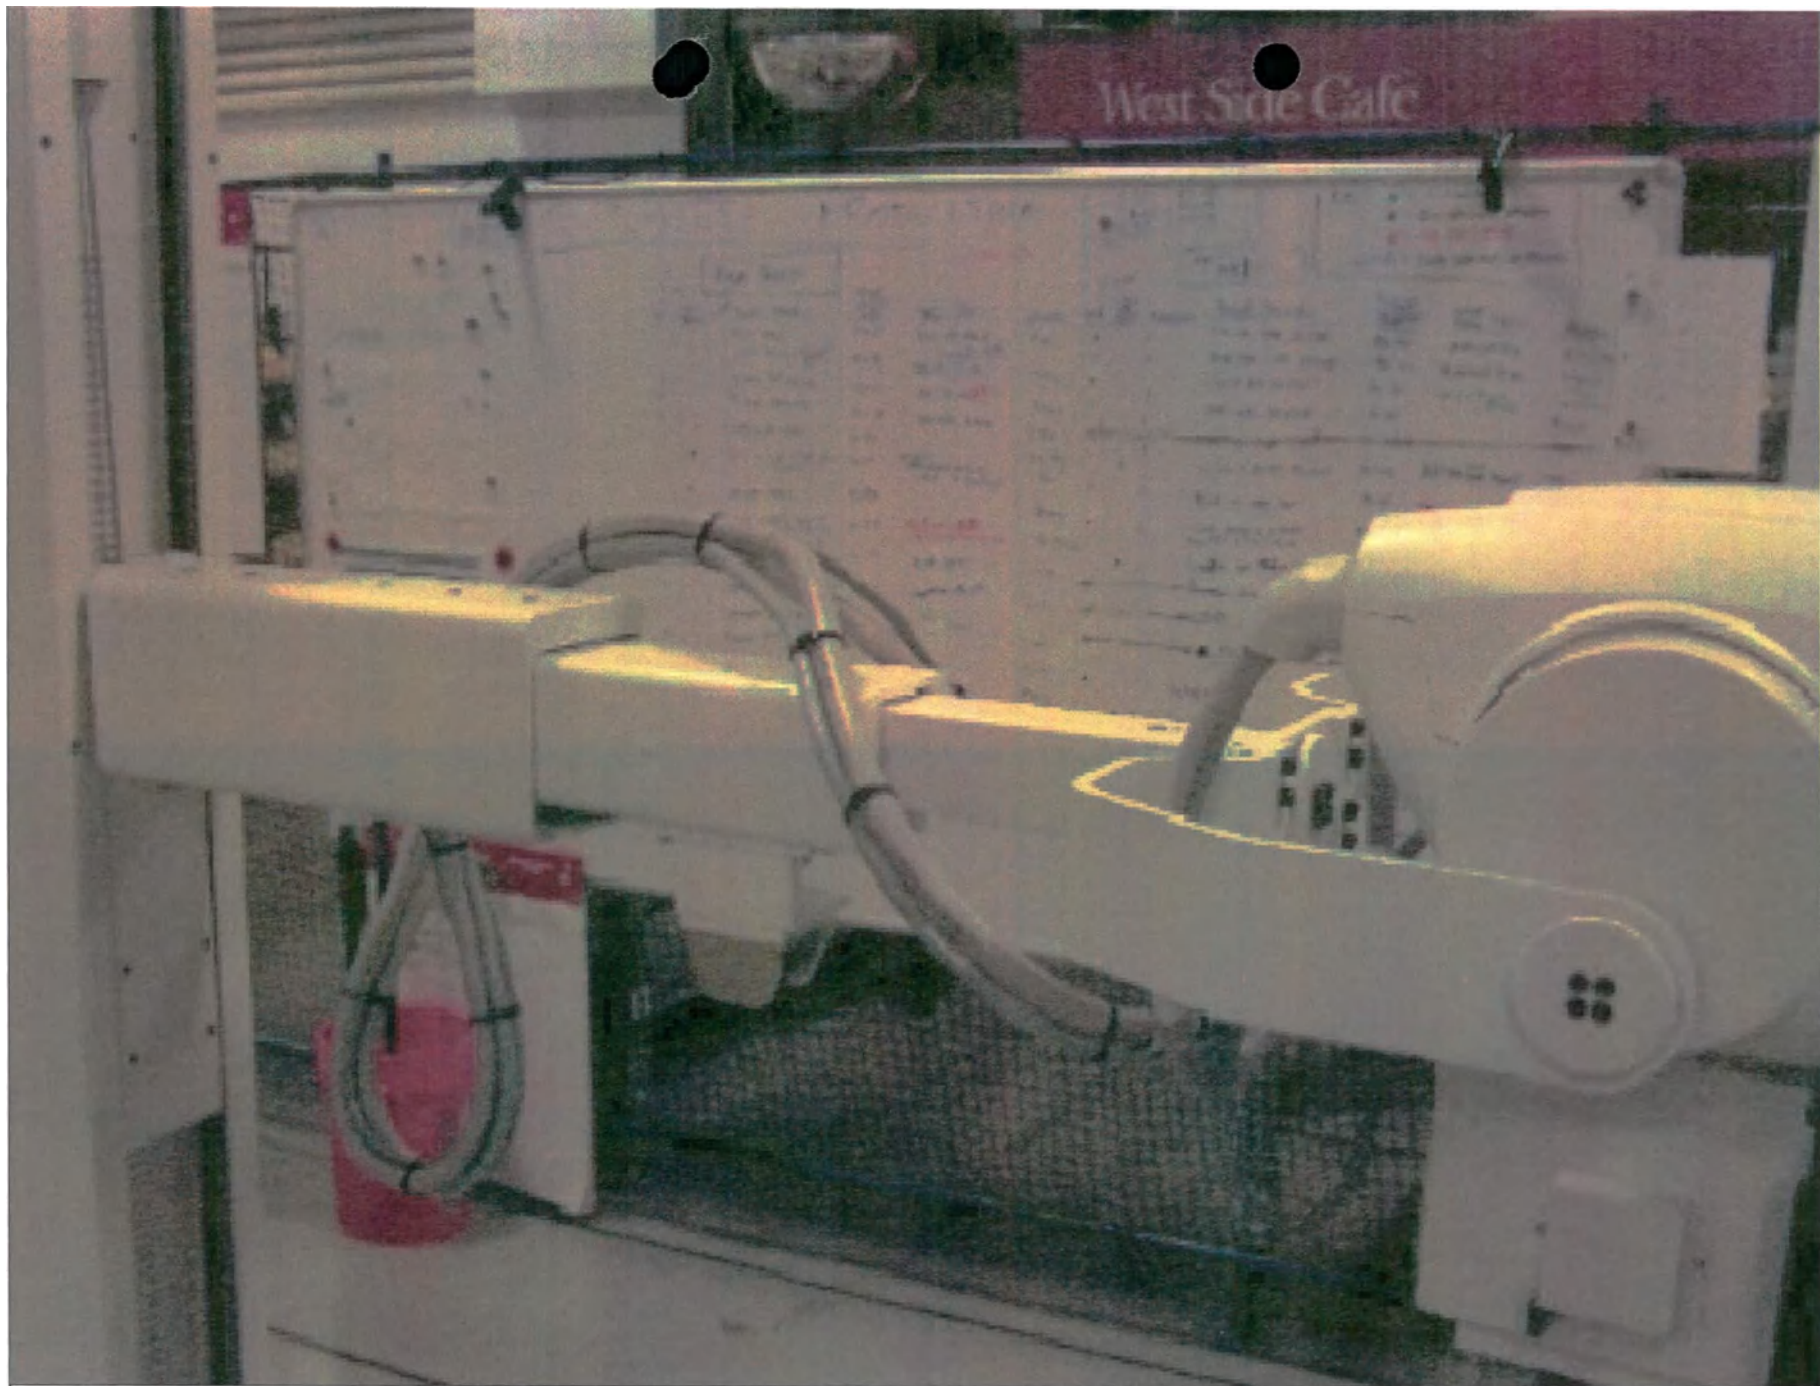


Рис. 10. Телескопический кронштейн

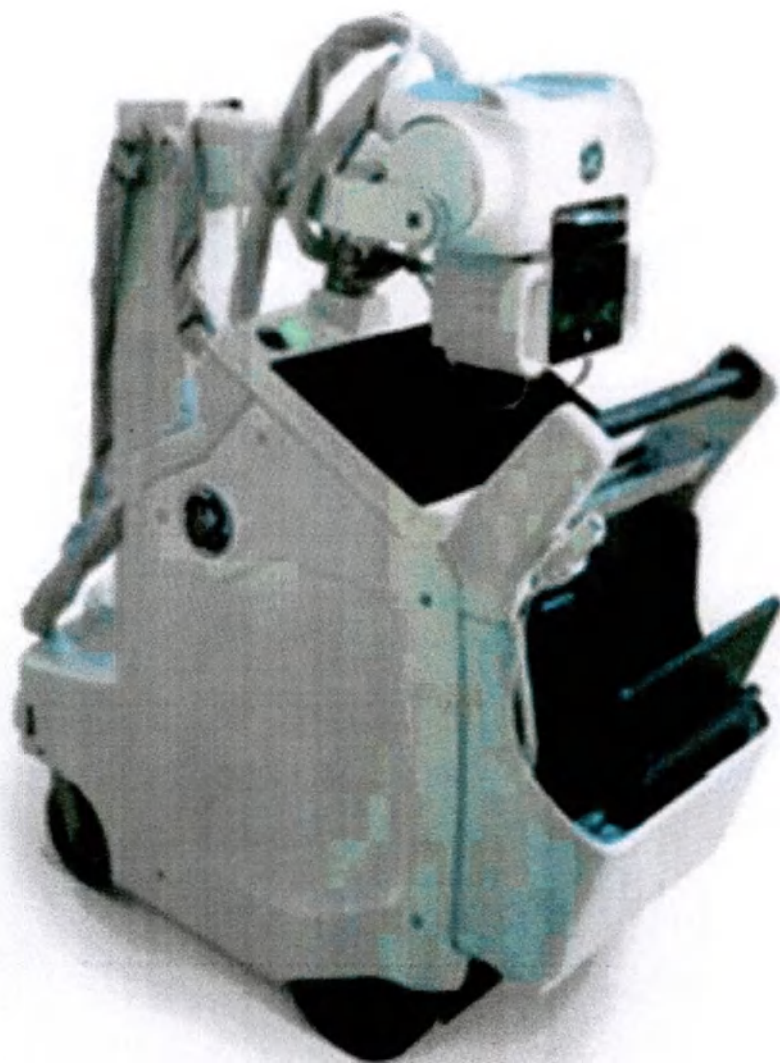


Рис. 11. Складная стойка

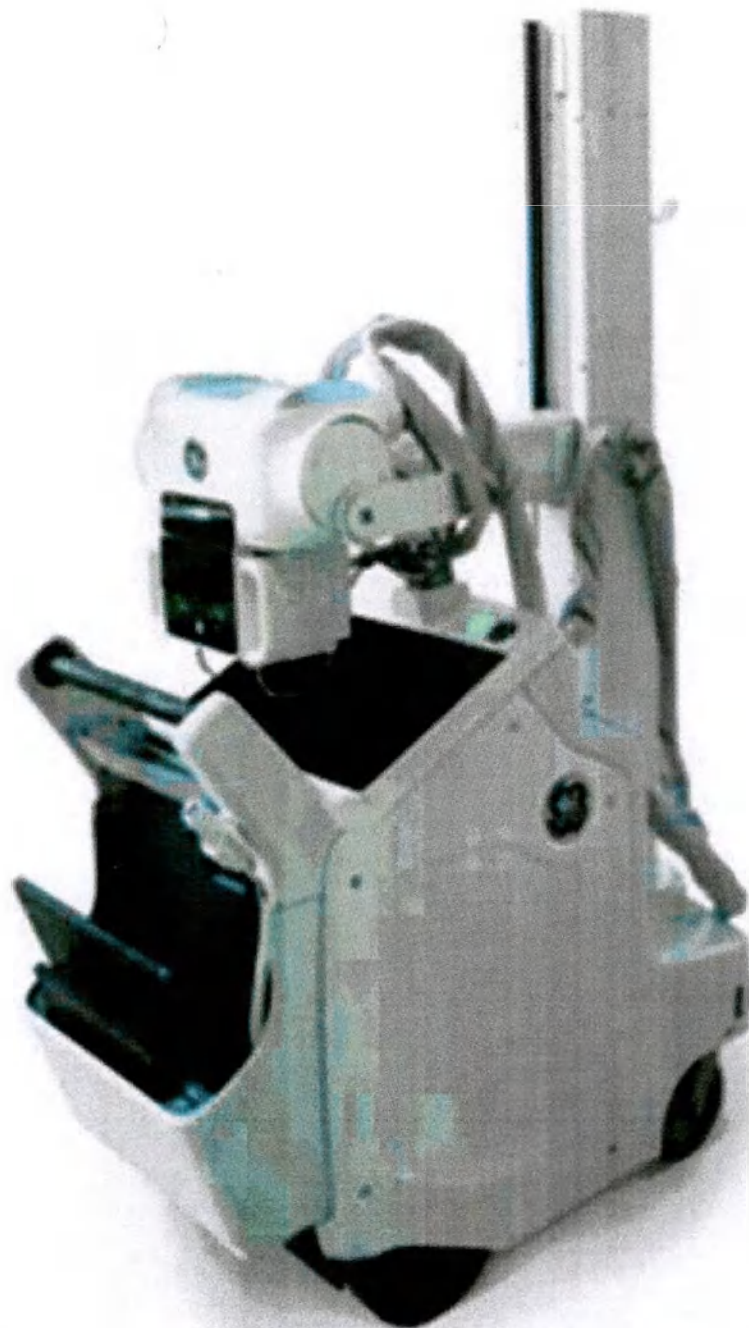


Рис. 12. Стационарная стойка

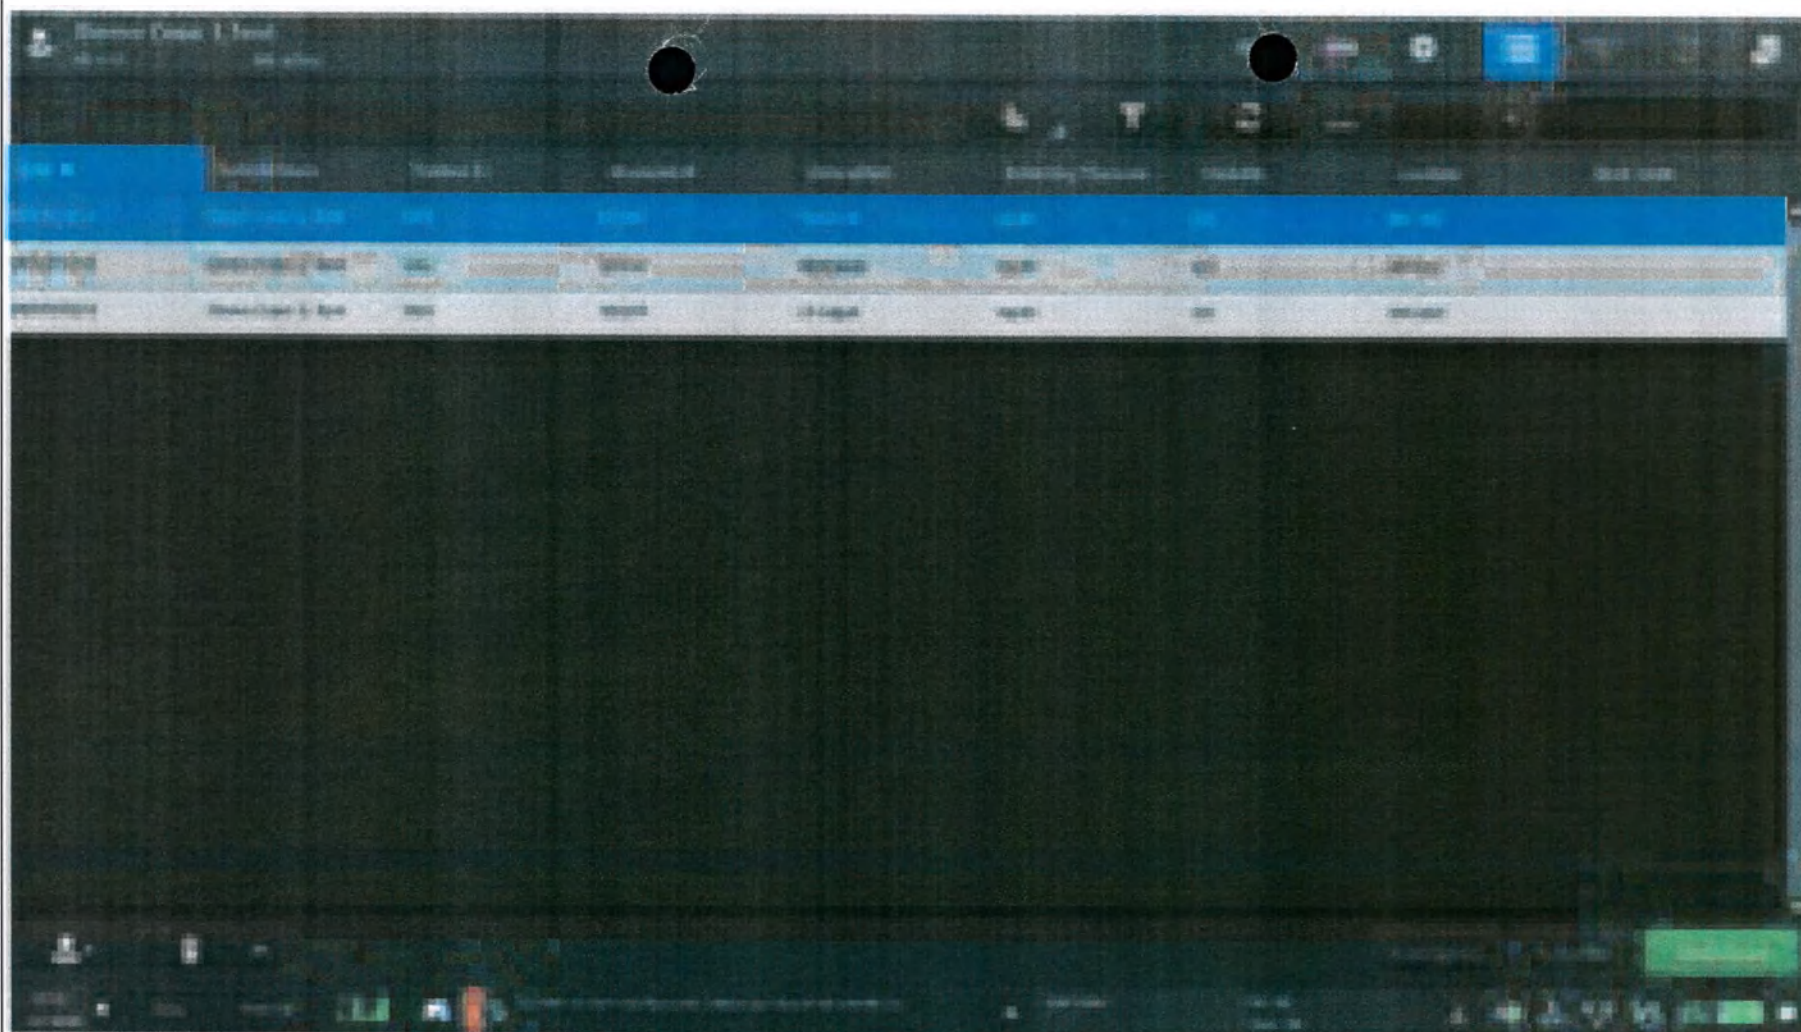


Рис. 13. Программное обеспечение для работы системы на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях

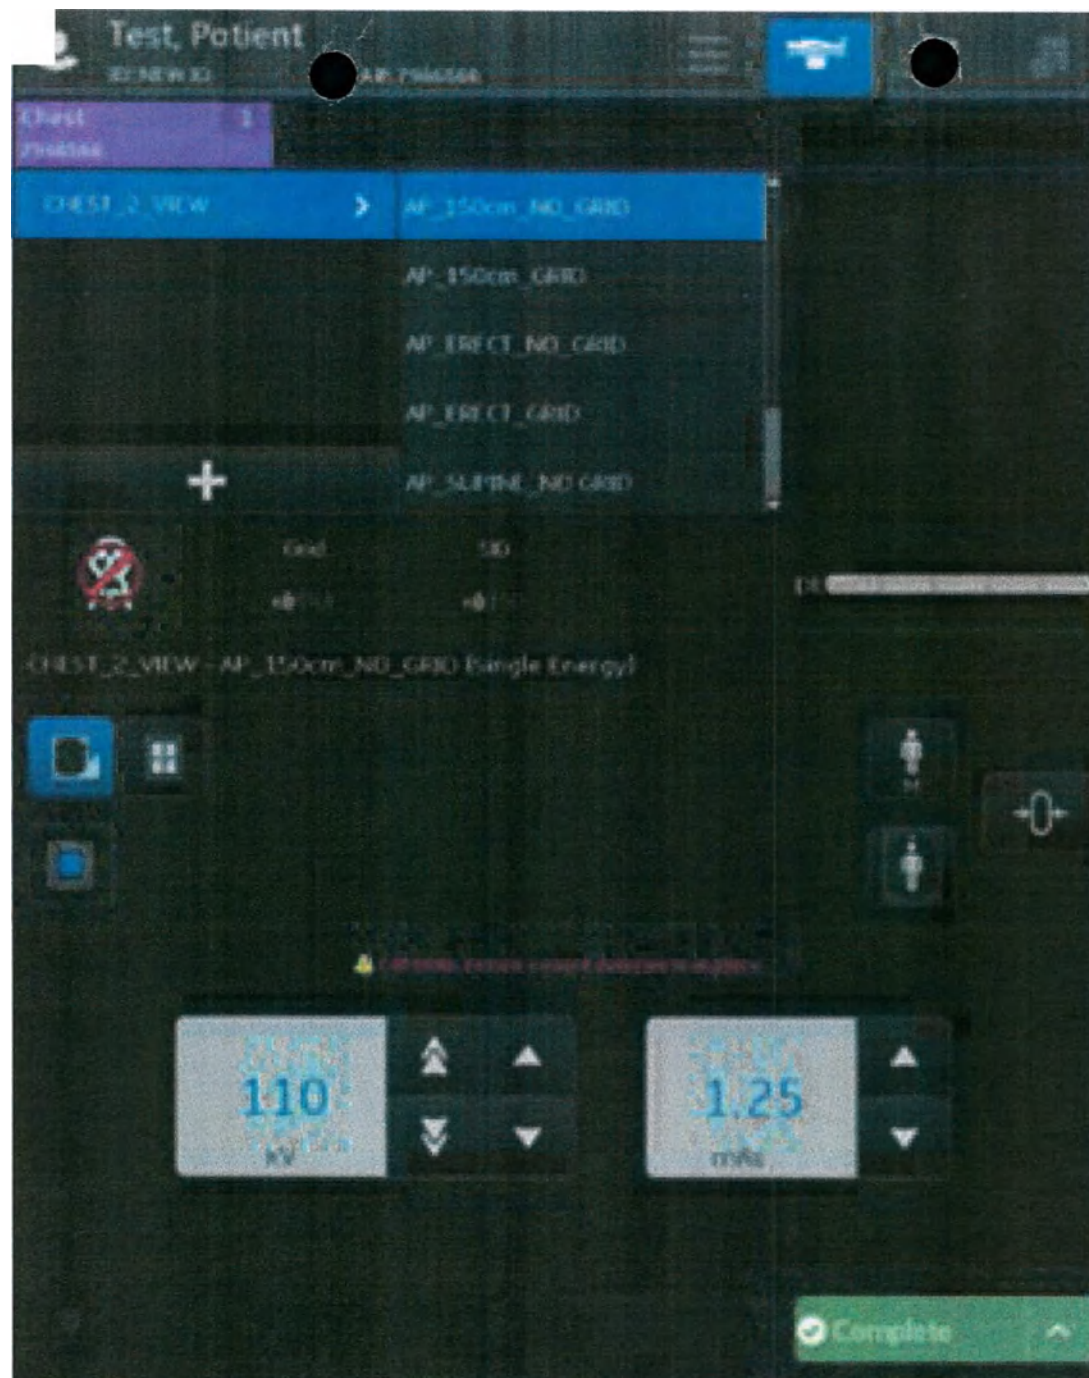
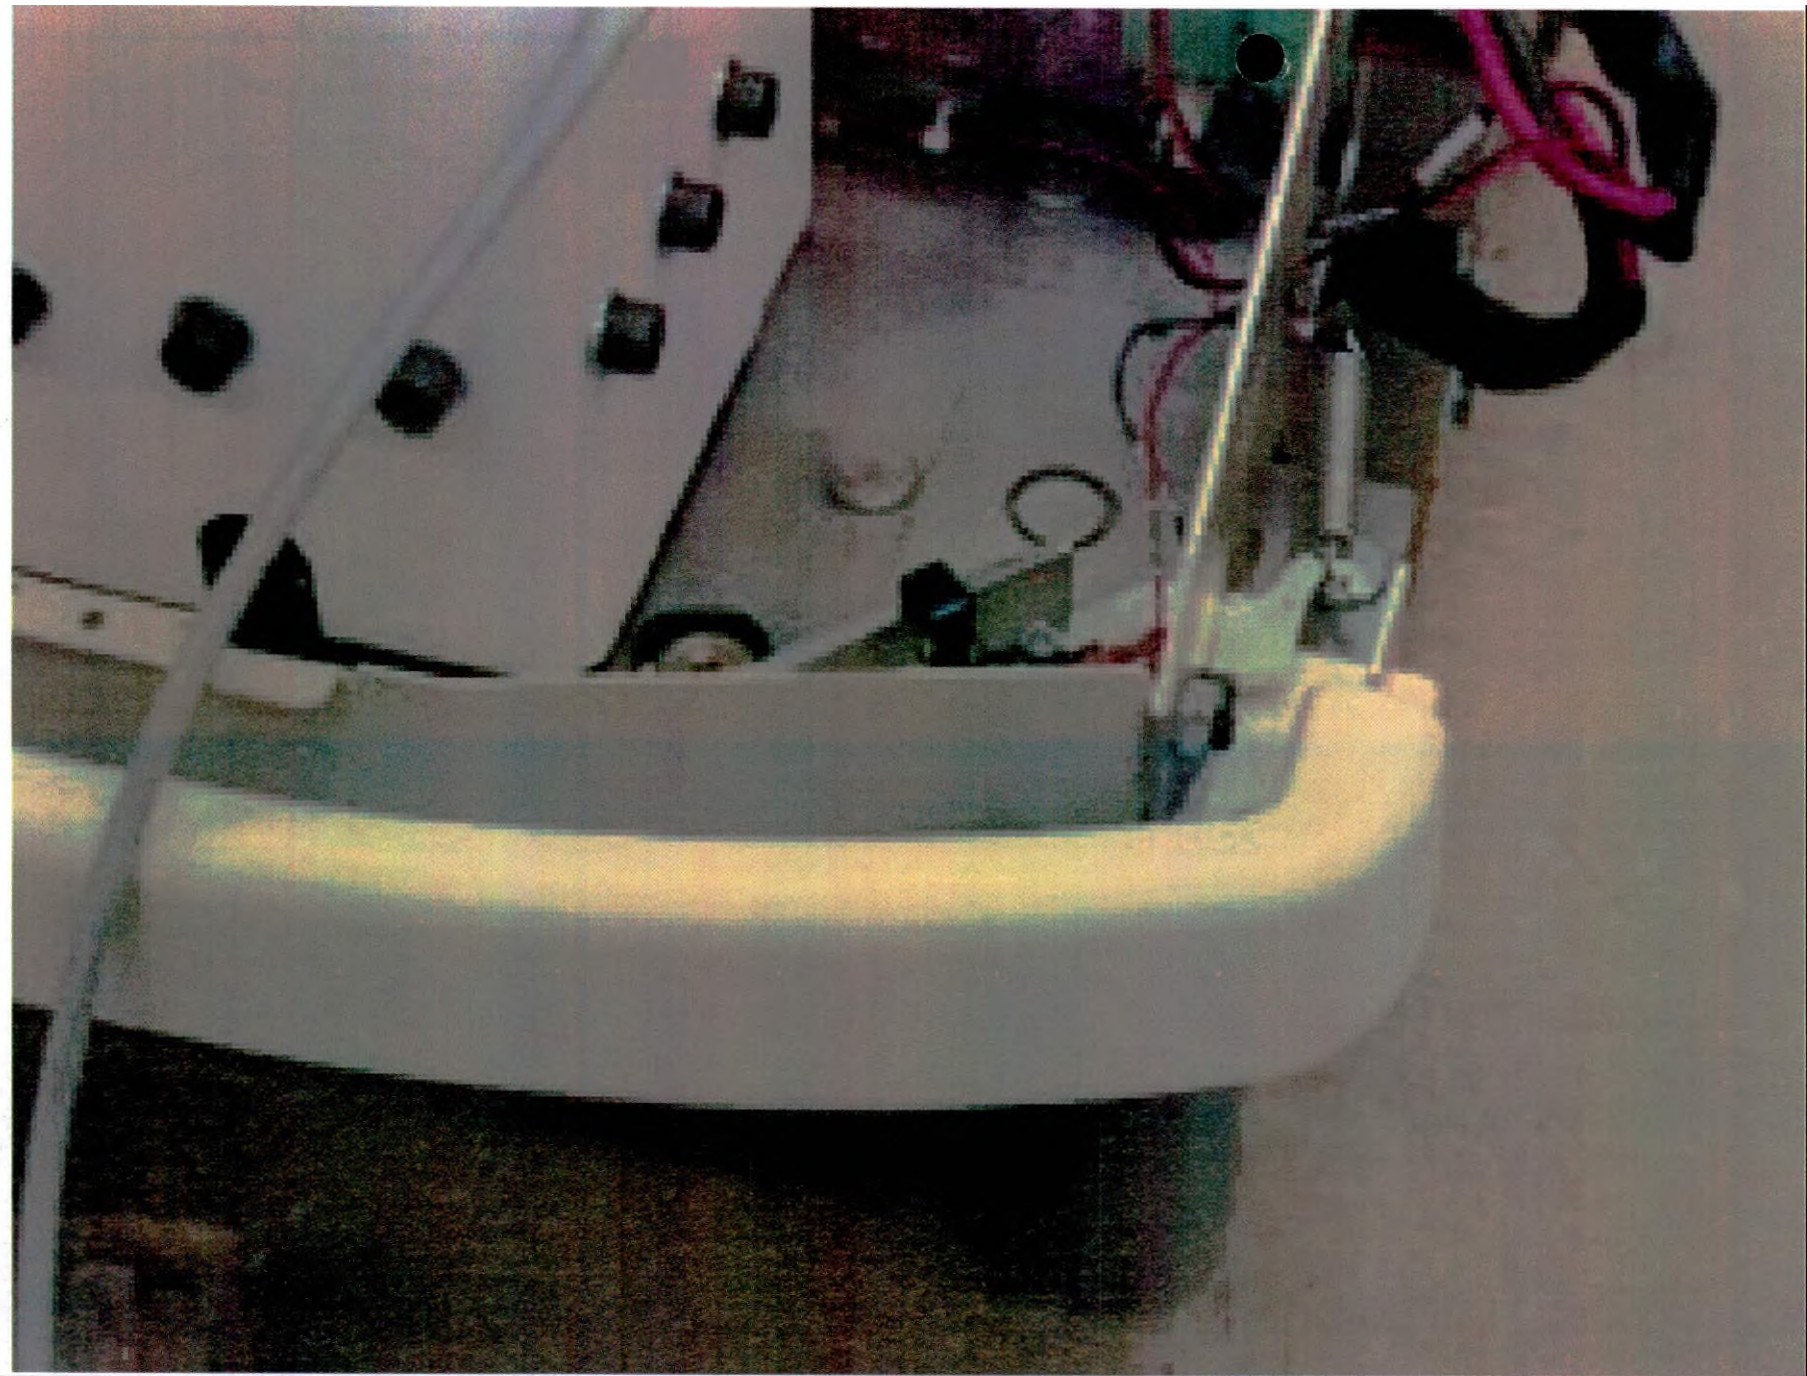


Рис. 14. Программное обеспечение для работы системы на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех



**Рис. 15. Передний бампер**



**Рис. 16. Лоток детектора**

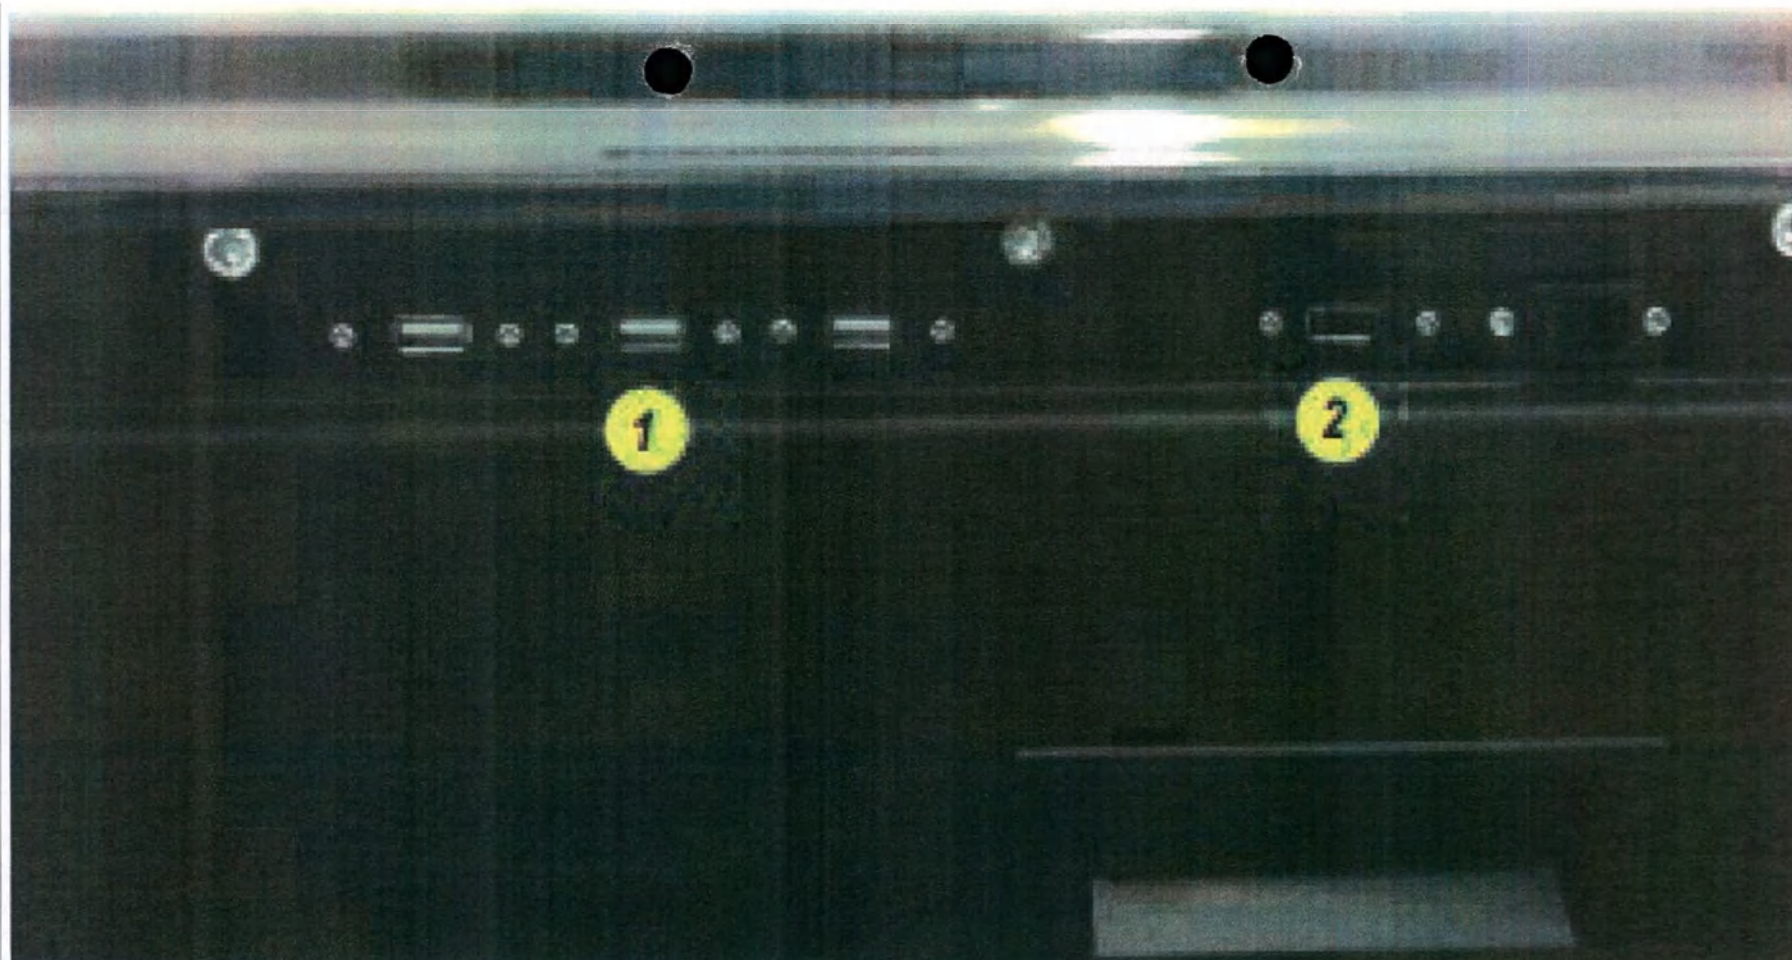


Рис. 17. Порты передачи данных

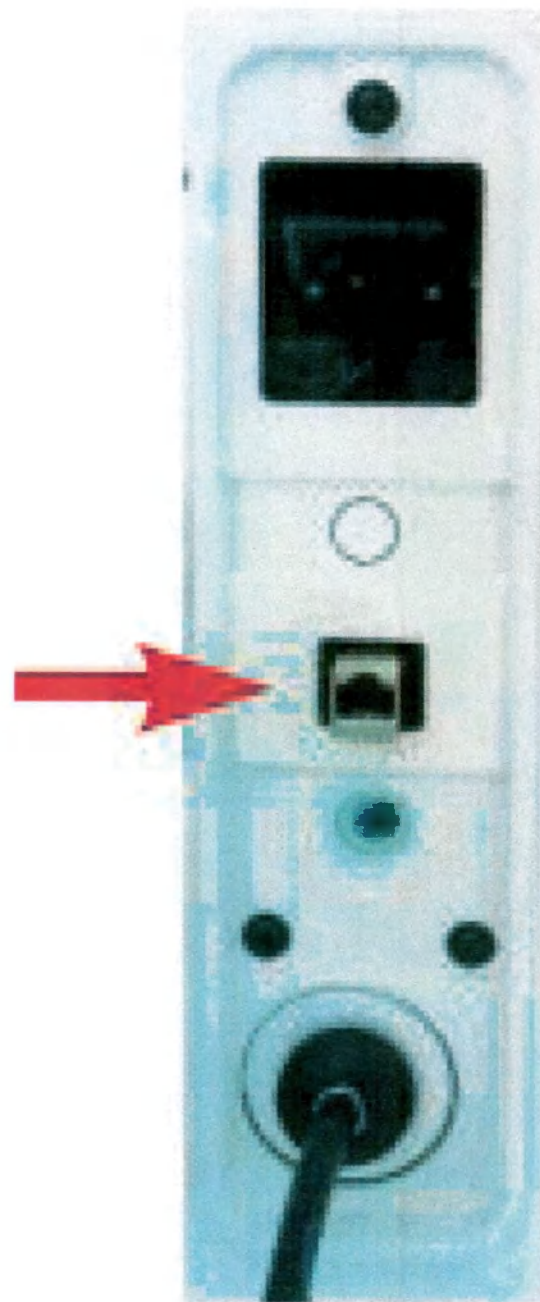


Рис. 18. Порты передачи данных

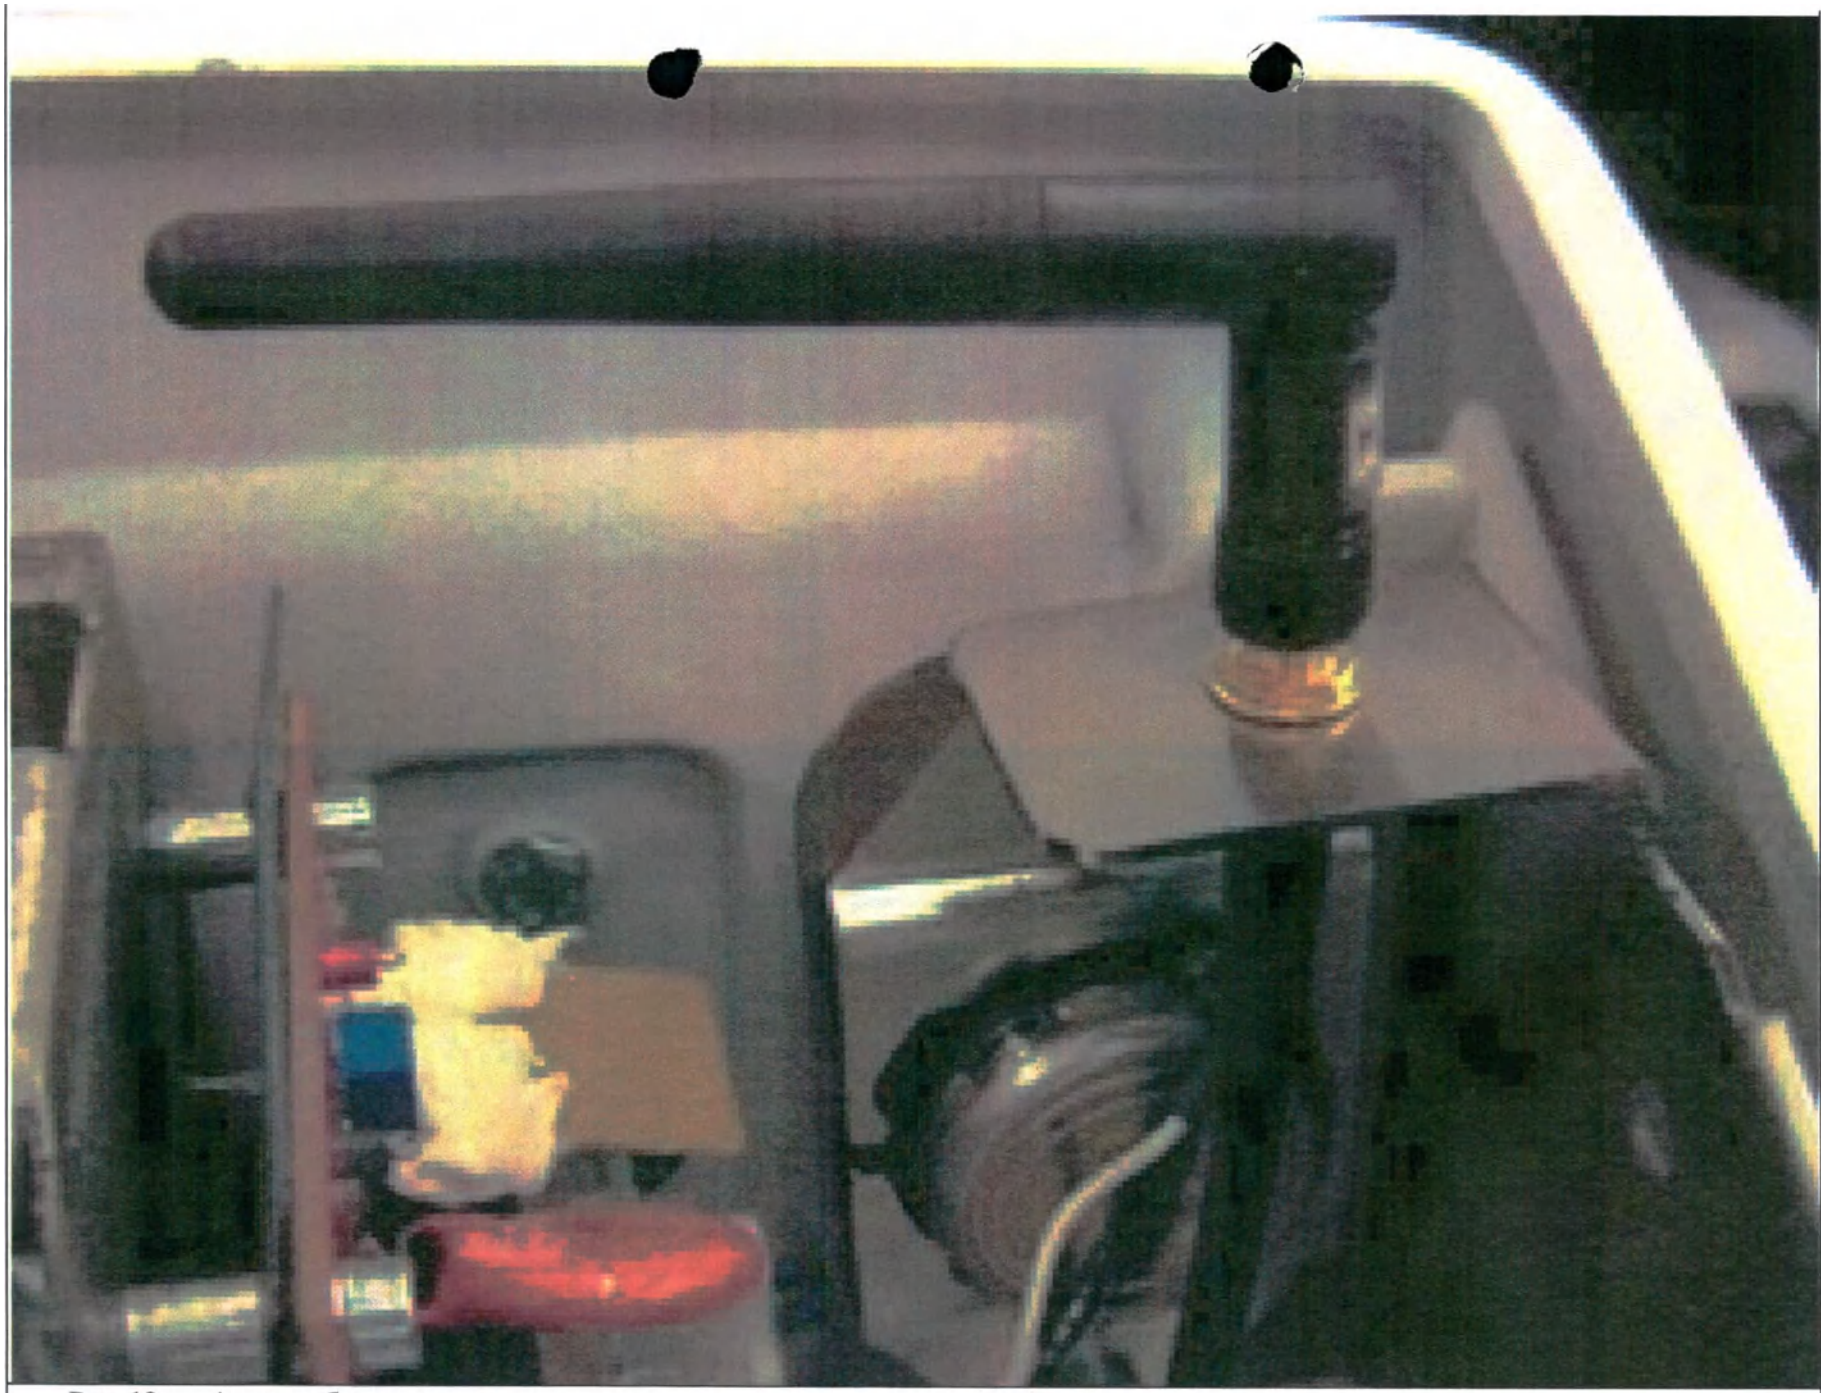


Рис. 19. Антенна беспроводного подключения

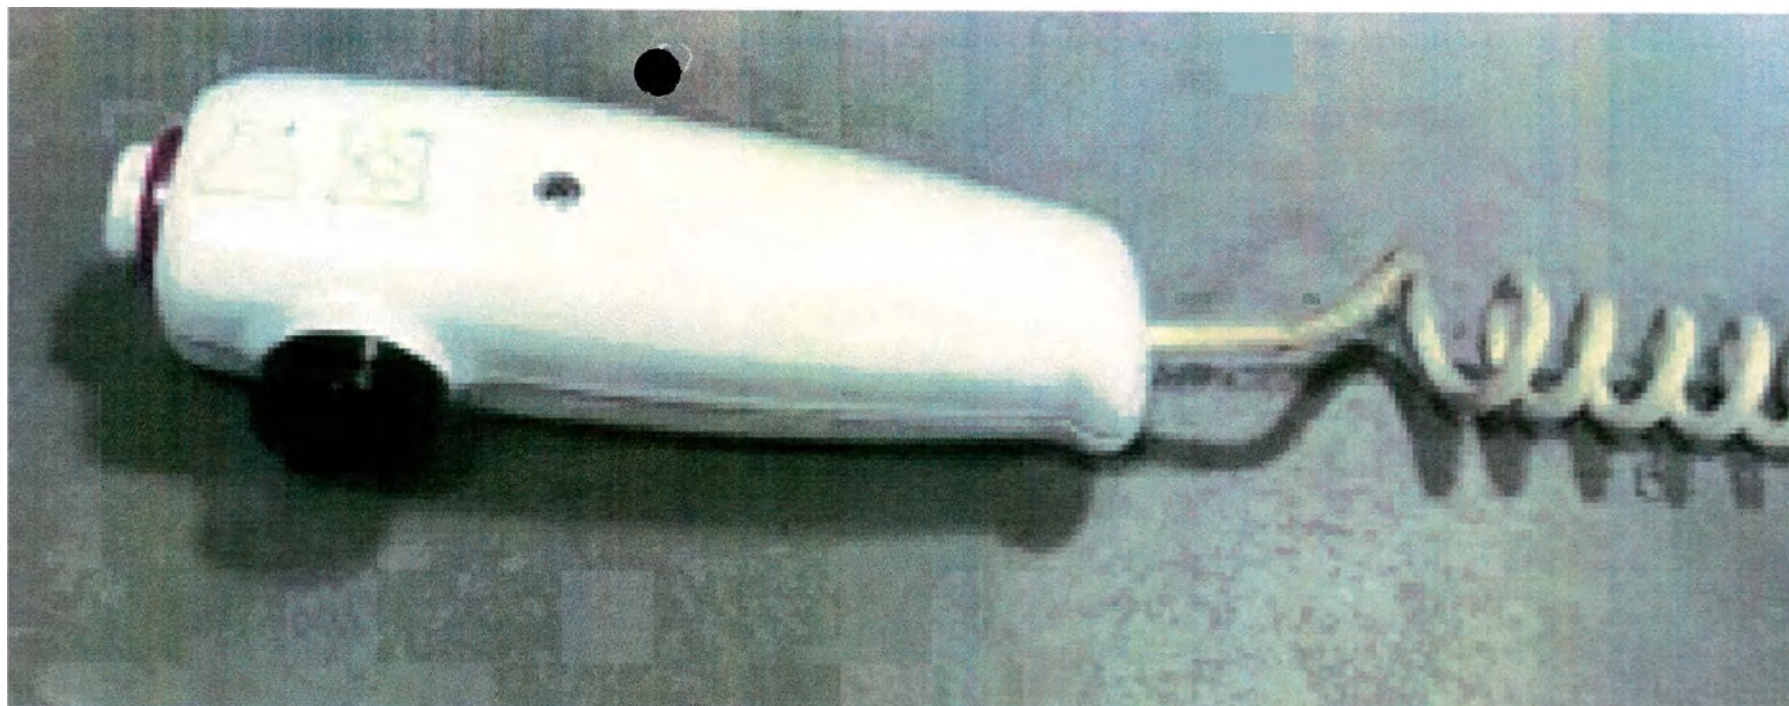


Рис. 20. Переключатель экспозиции ручной



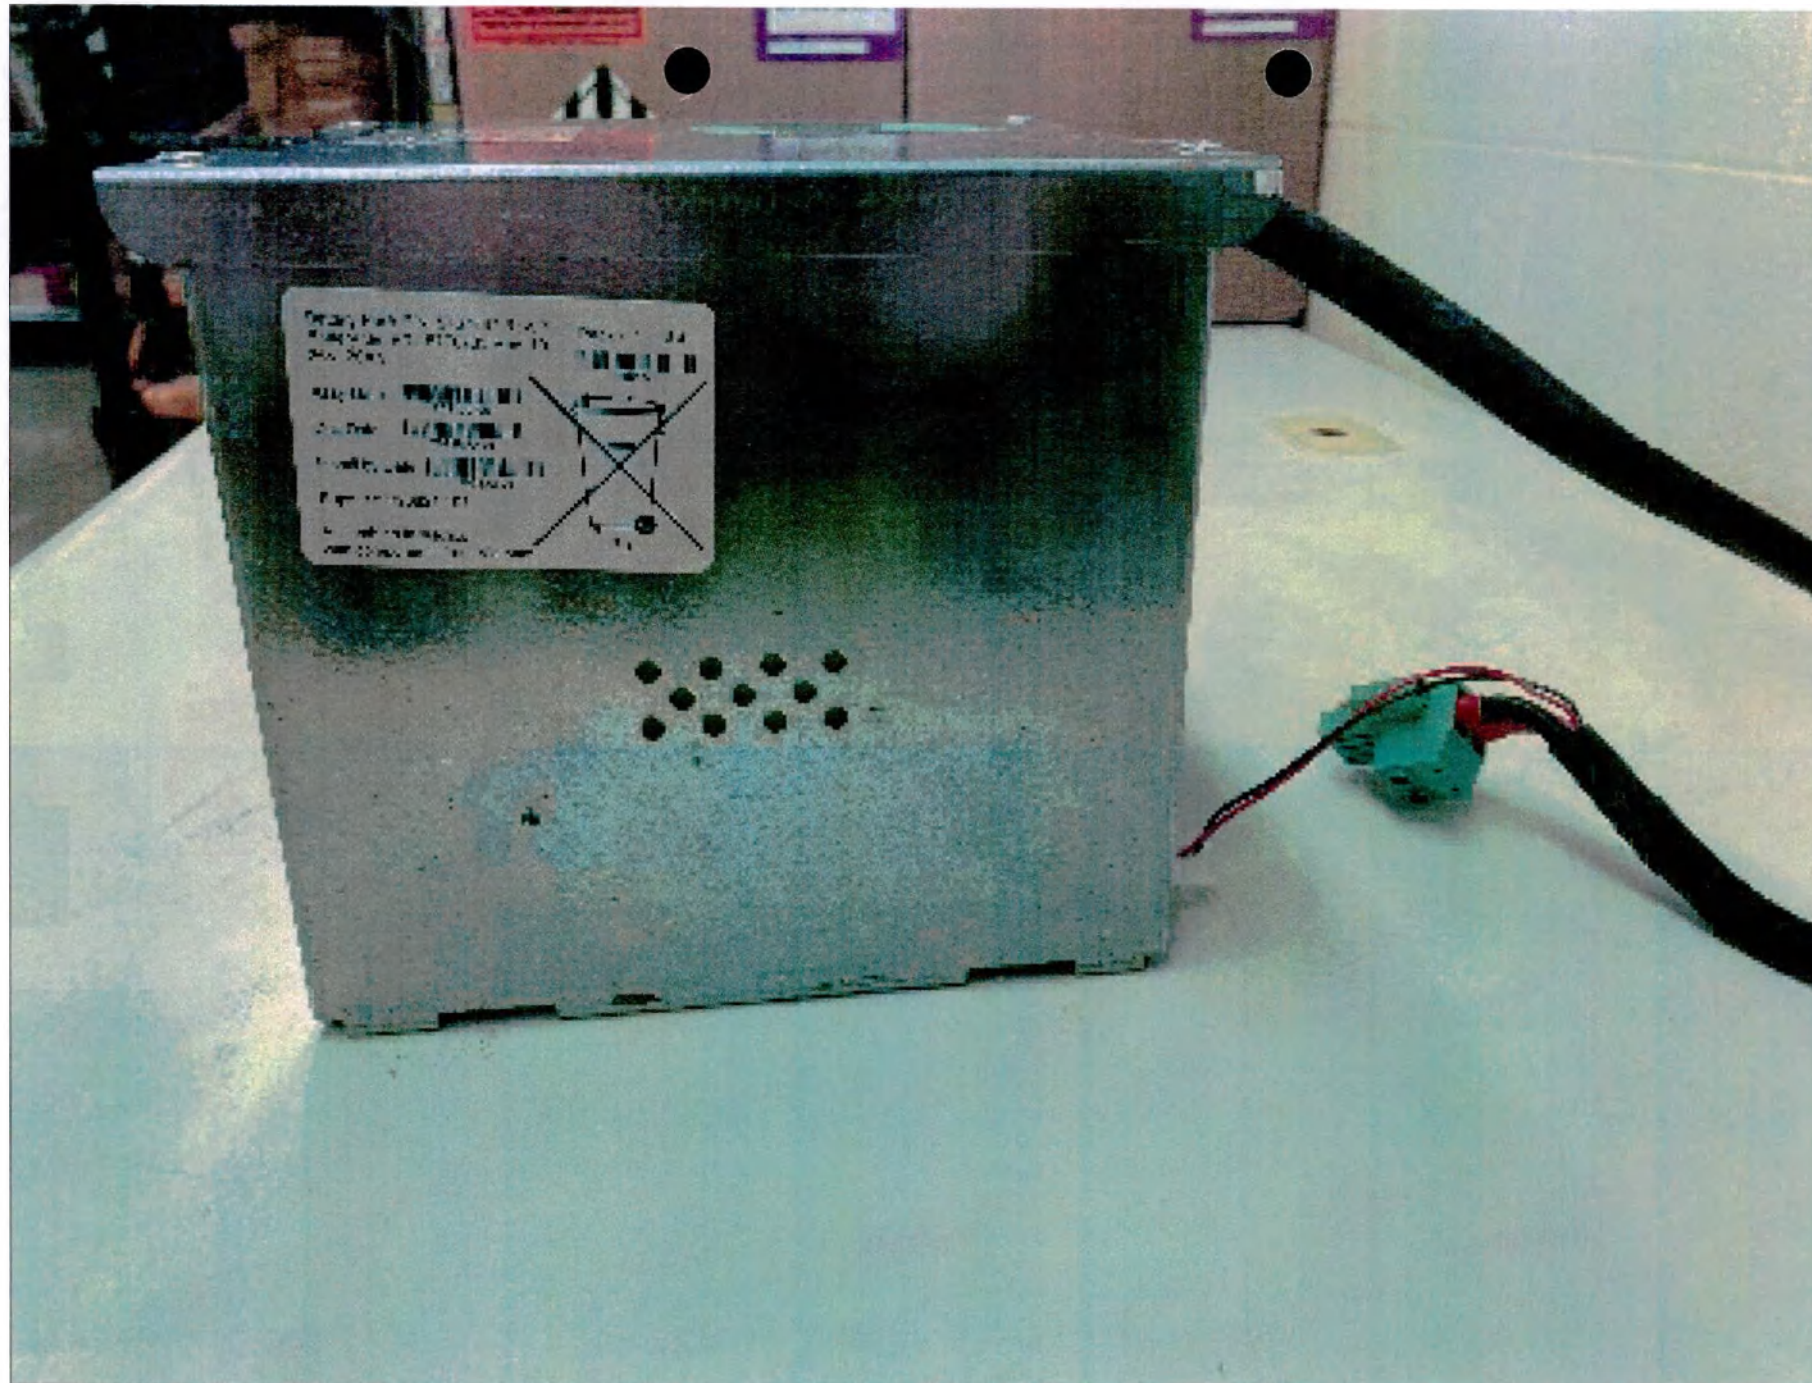


Рис. 21. Батарея системы



**Рентгеновская система AMX Navigate**  
Руководство оператора

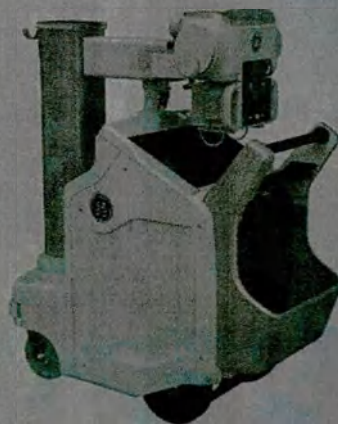

584572-1RU  
Редакция 5  
Russian / Русский

© 2010 - 2023 GE HealthCare  
GE является товарным знаком компании General Electric Company, используемым на основании лицензий на товарный знак.

Рис. 22. Эксплуатационная документация



Рис. 23. Цифровой детектор



Рис. 24. Цифровой детектор

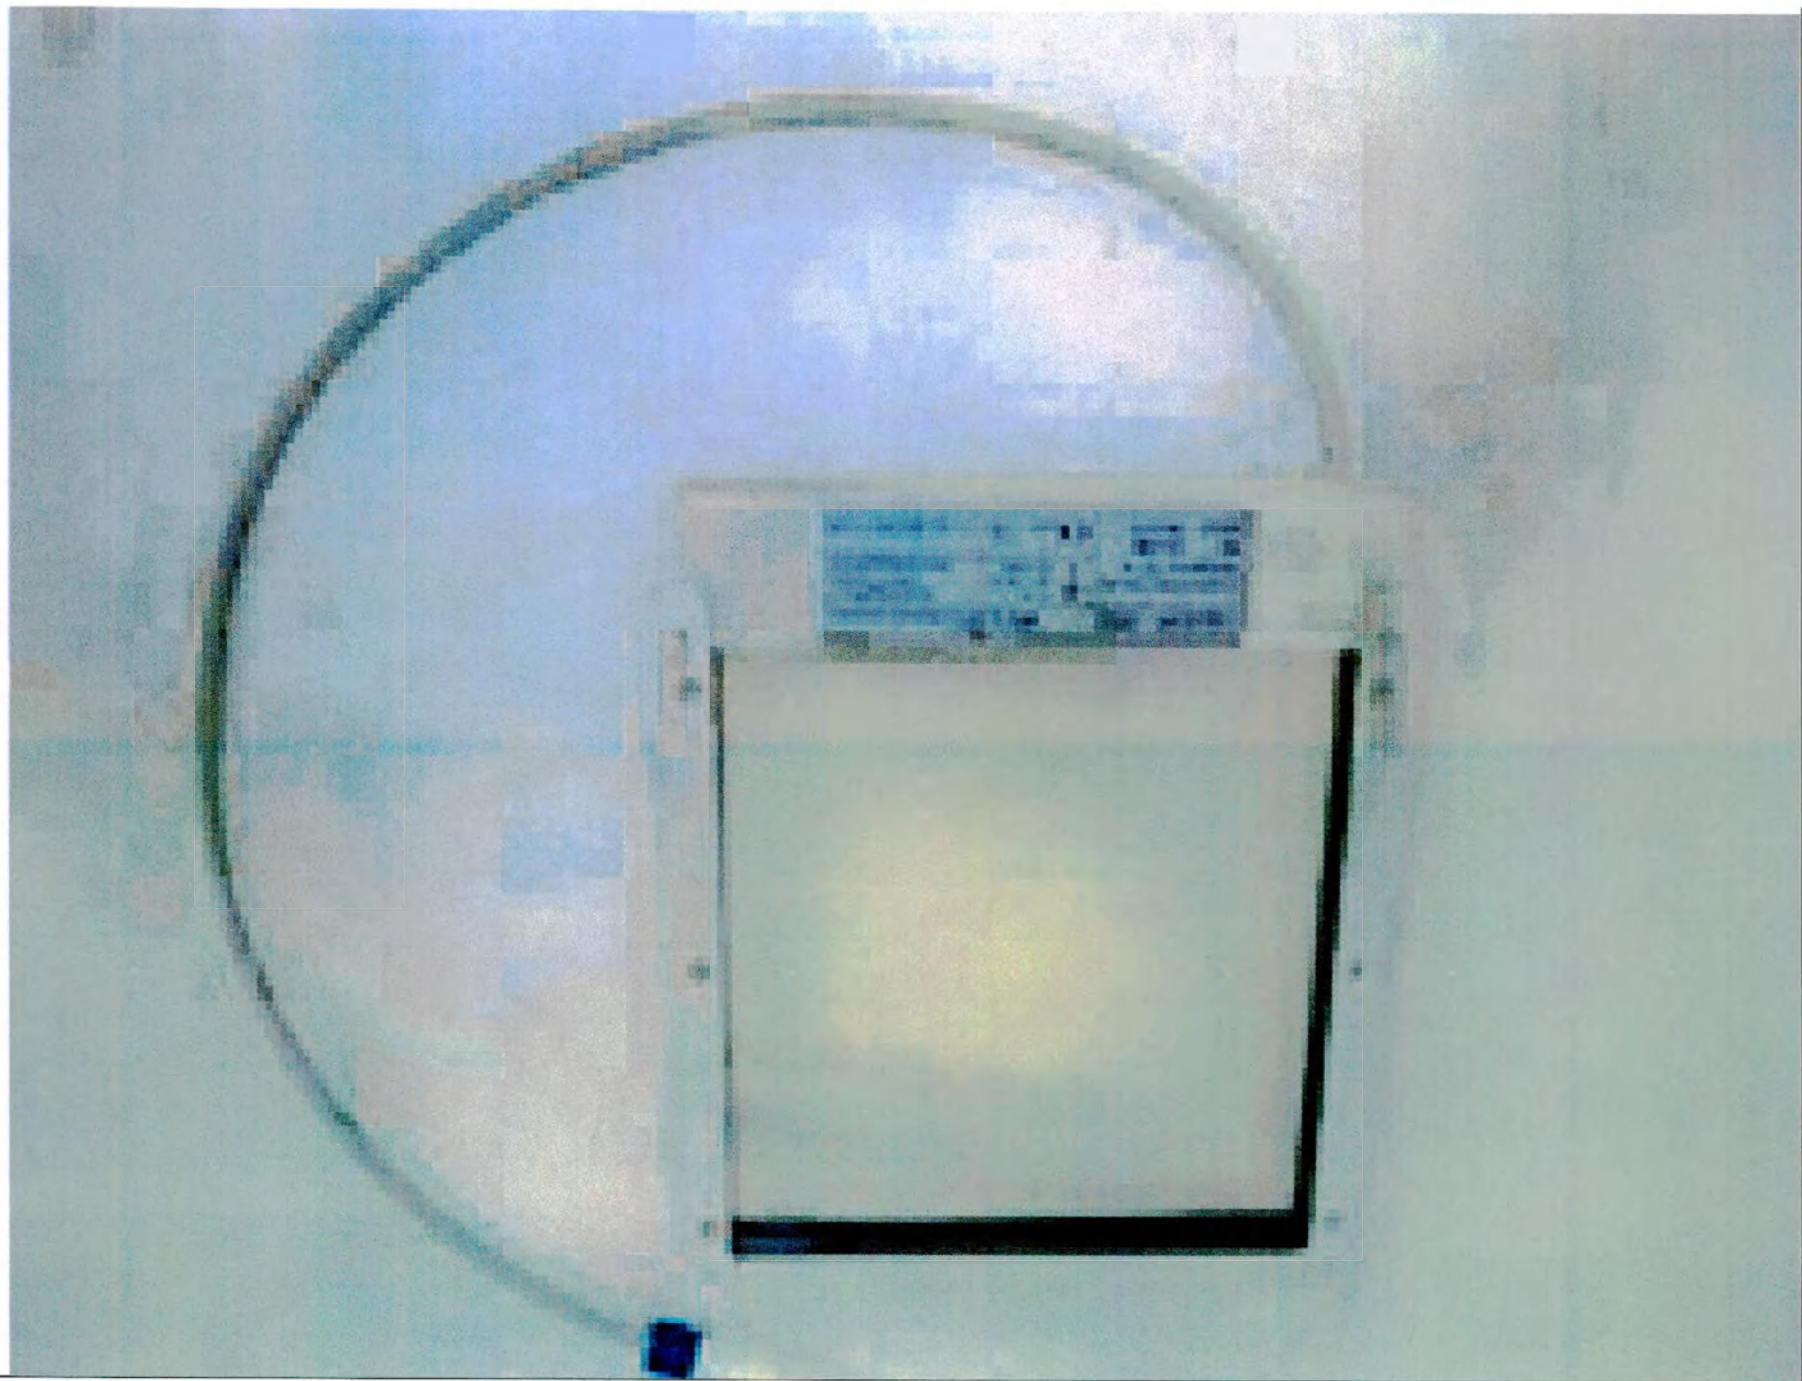


Рис. 25. Измеритель произведения дозы на площадь



Рис. 26. Пульт дистанционного управления



Рис. 27. Пульт дистанционного управления



**Рис. 28. Решетка детектора**

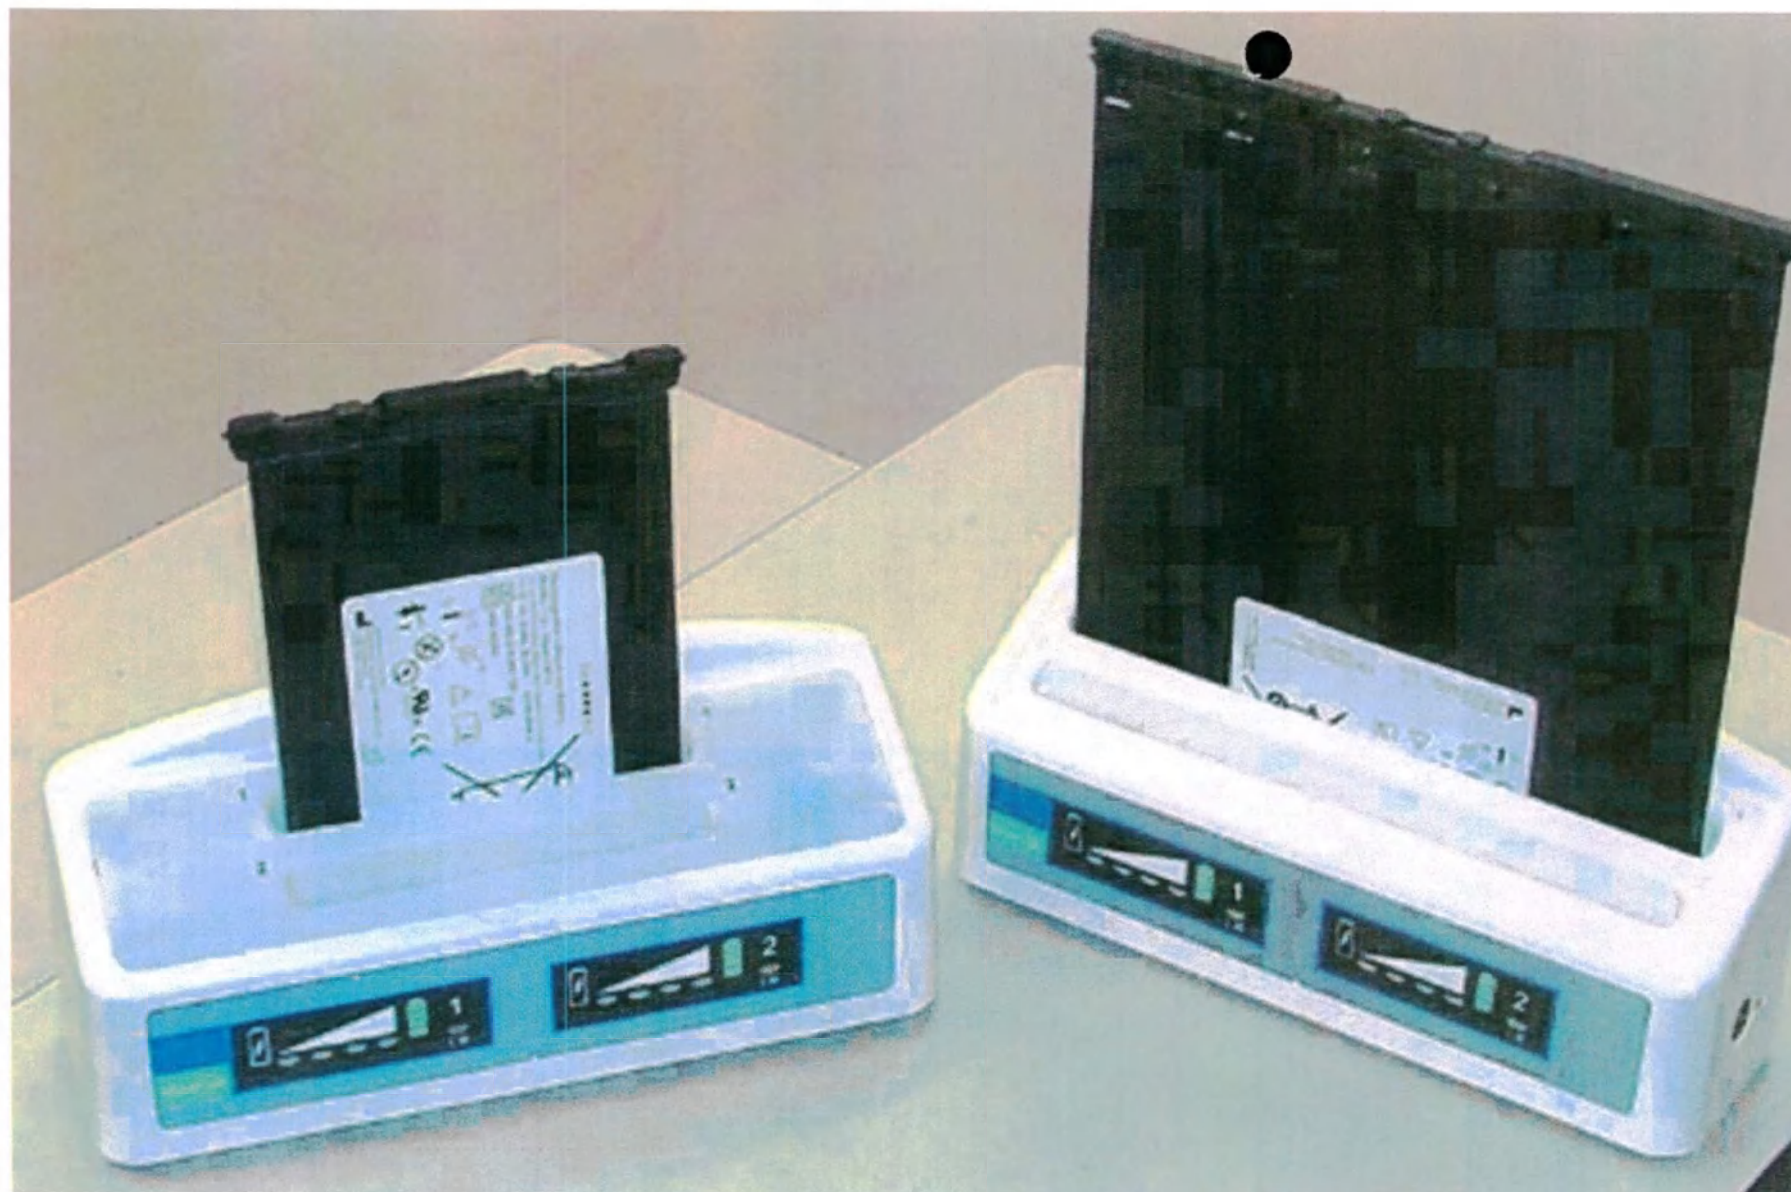
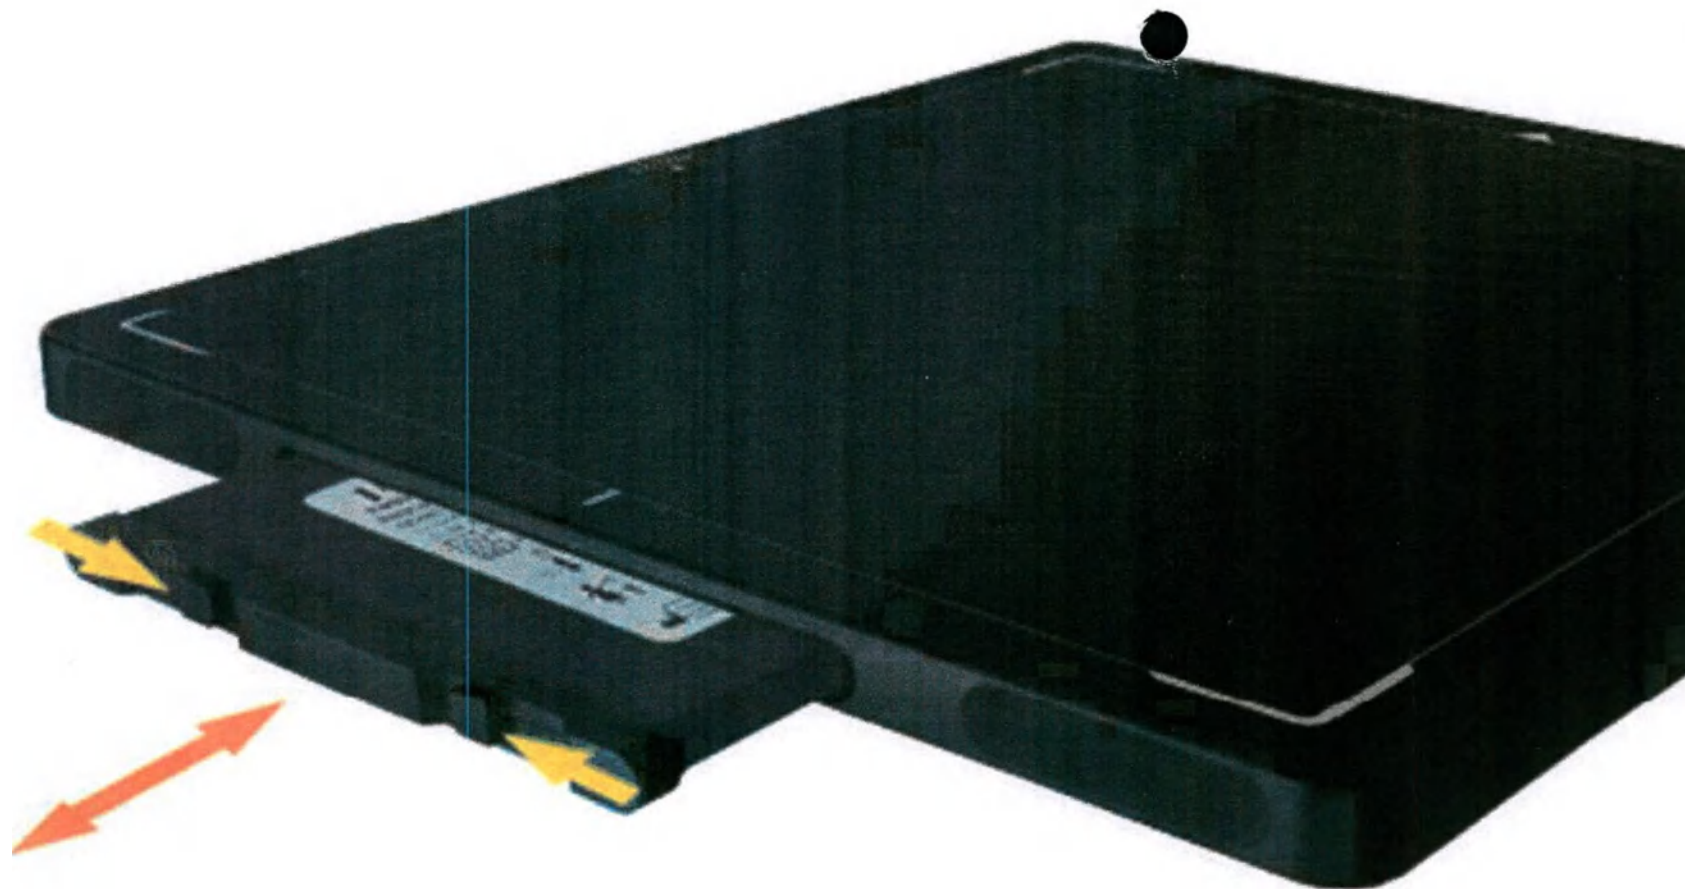


Рис. 29. Настольное зарядное устройство



**Рис. 30. Аккумуляторная батарея для детекторов**





Рис. 32. Ручка детектора с решеткой

Рис. 12-13 Ручка детекто| без решетки

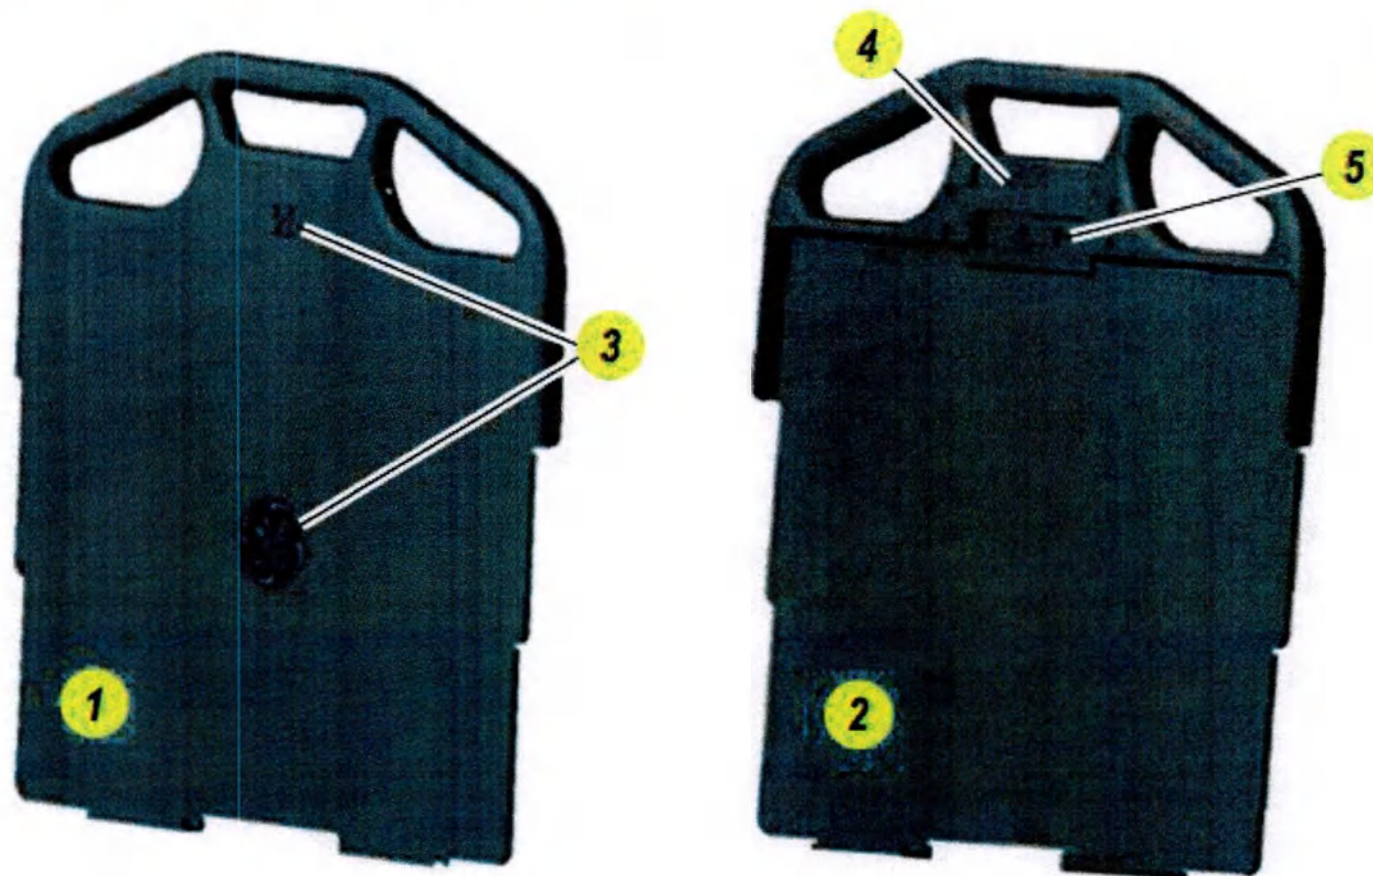


Рис. 33. Ручка детектора без решетки

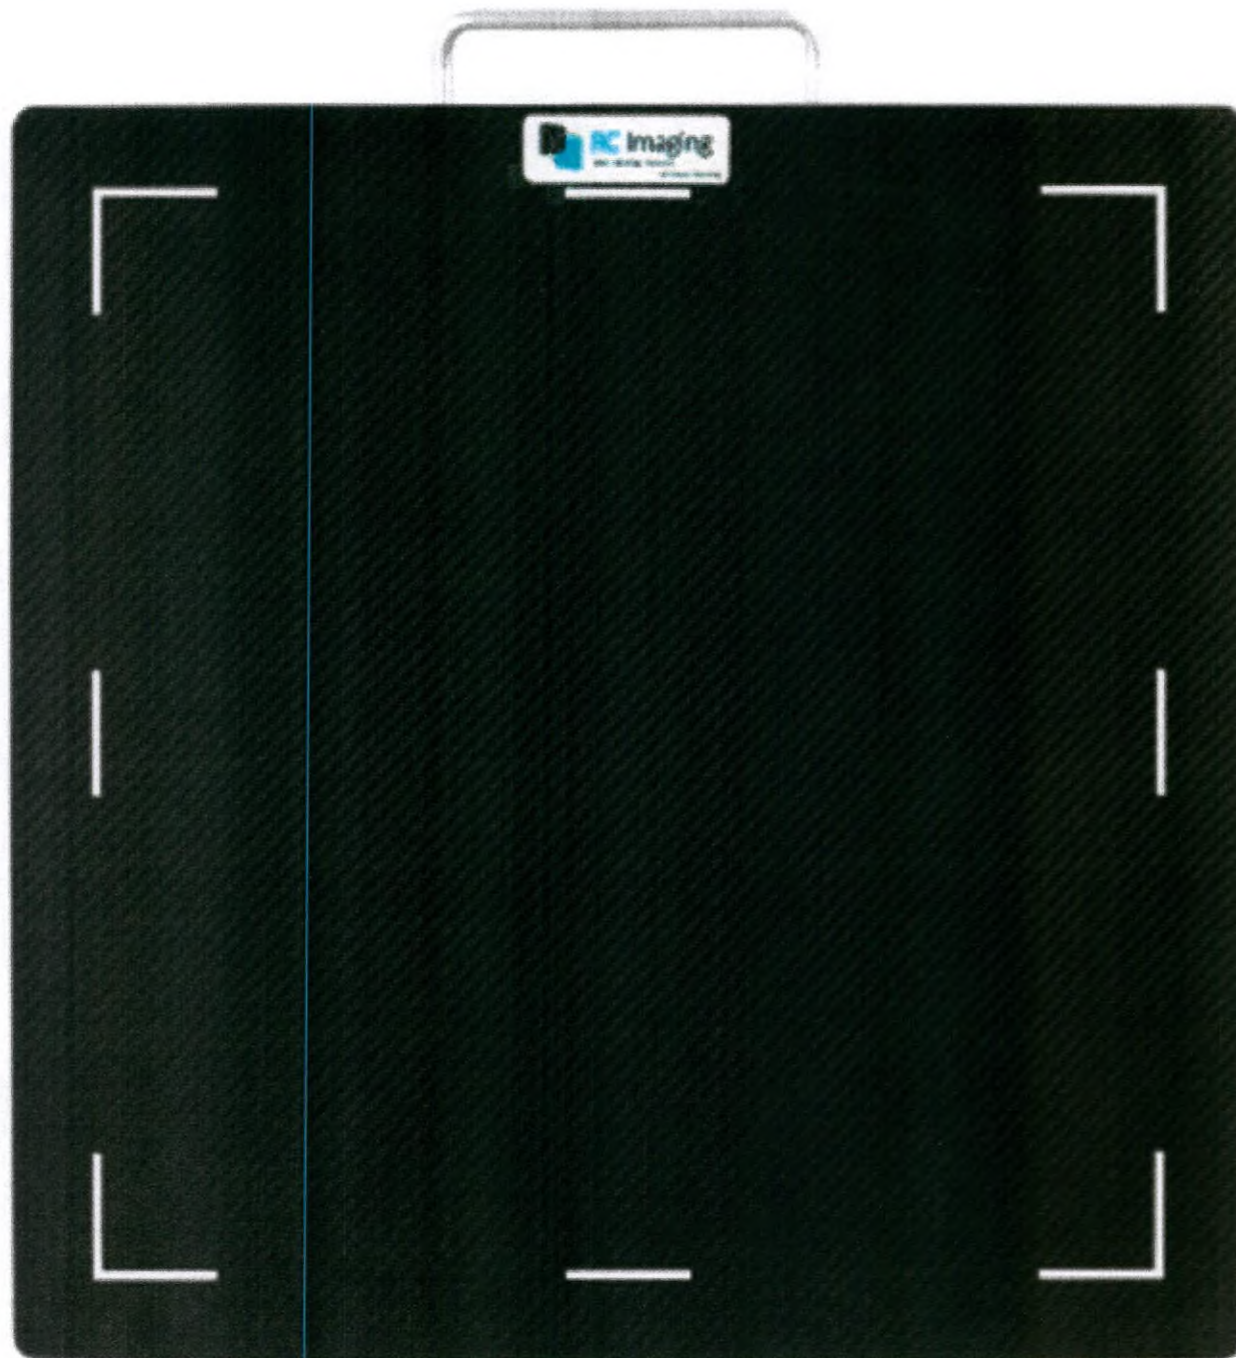
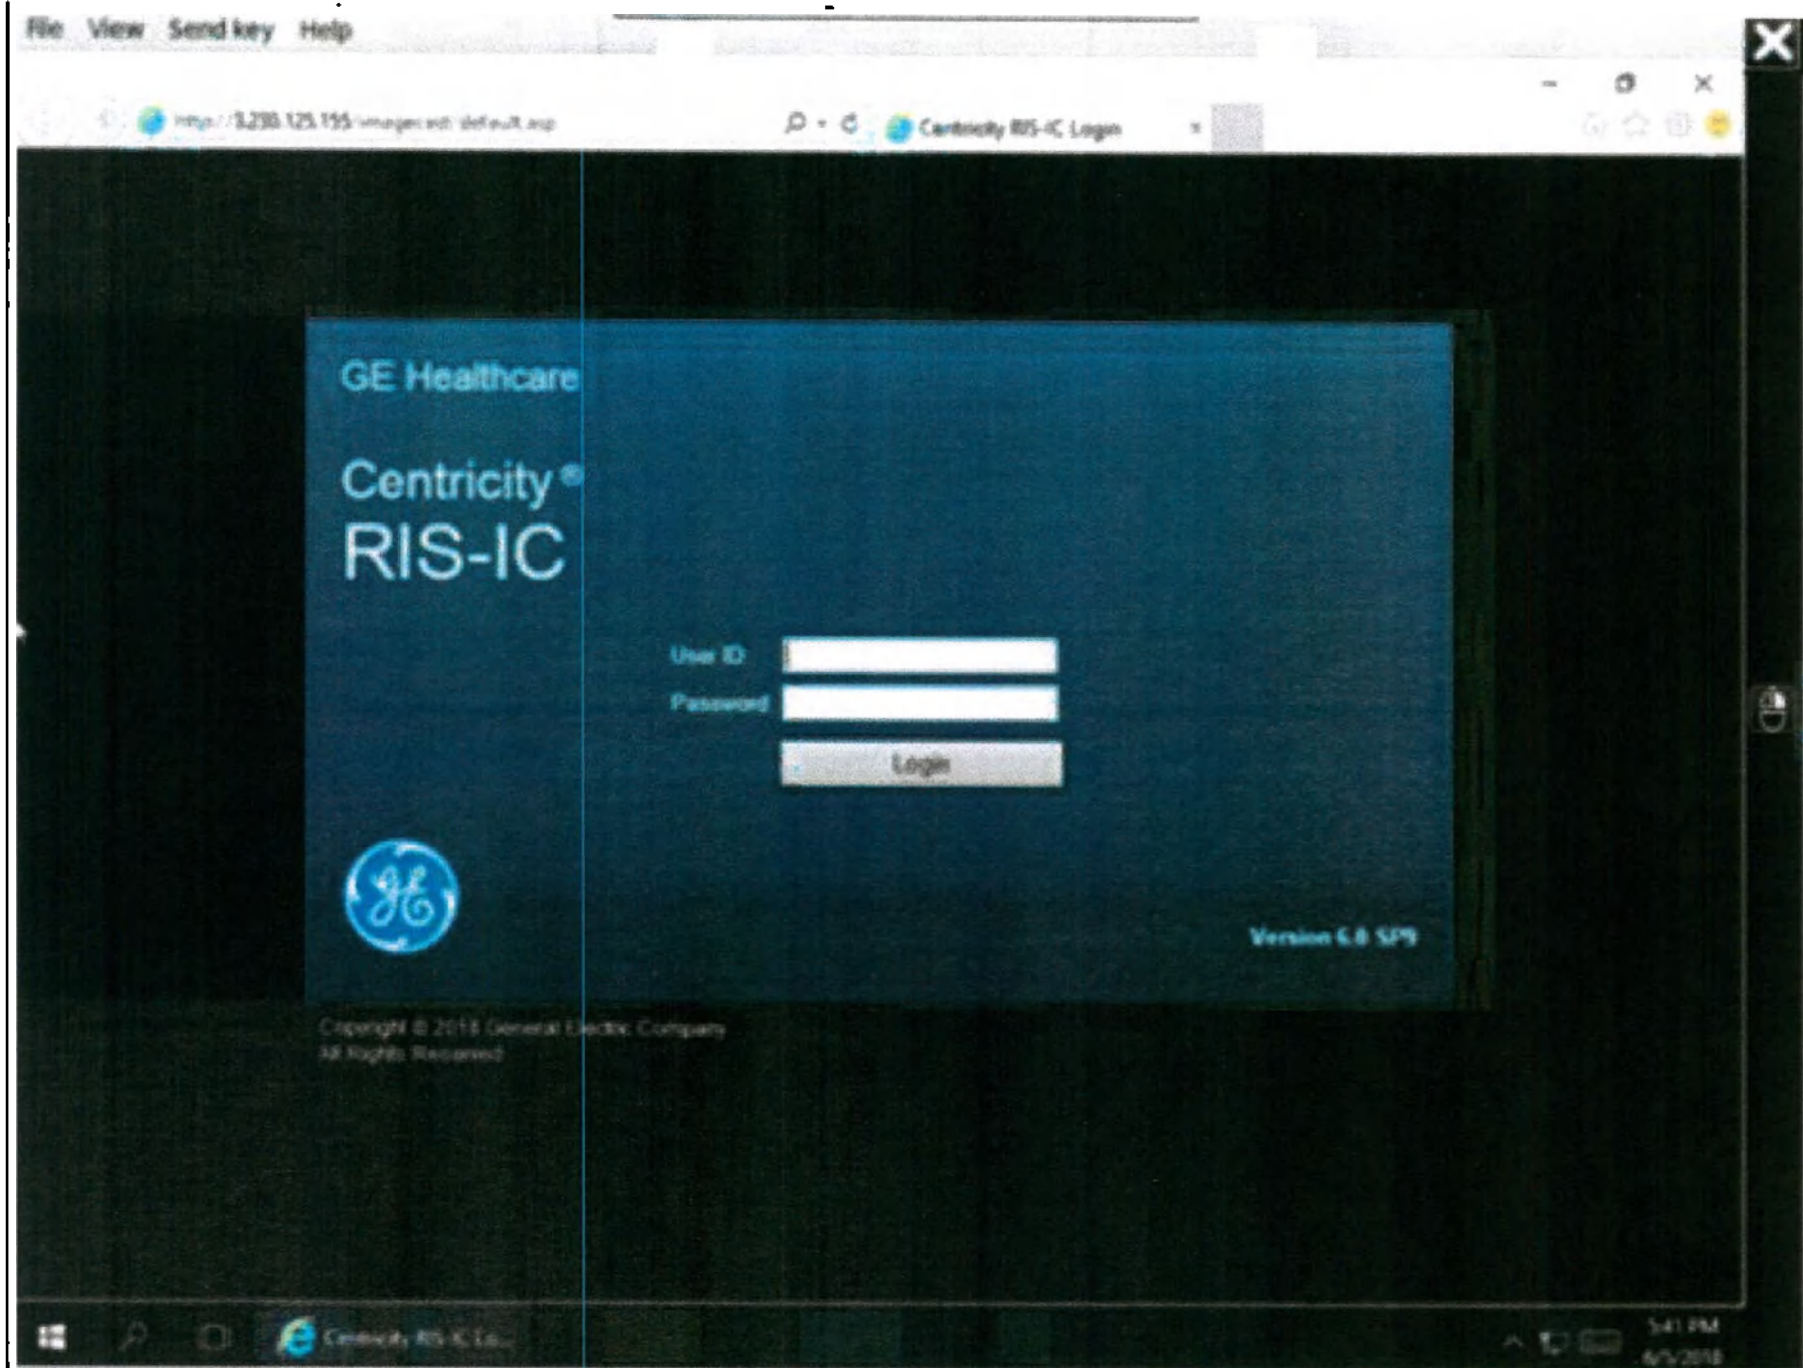


Рис. 34. Крышка весовой нагрузки



**Рис. 35. Программное обеспечение для интеграции в больничную сеть на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех**

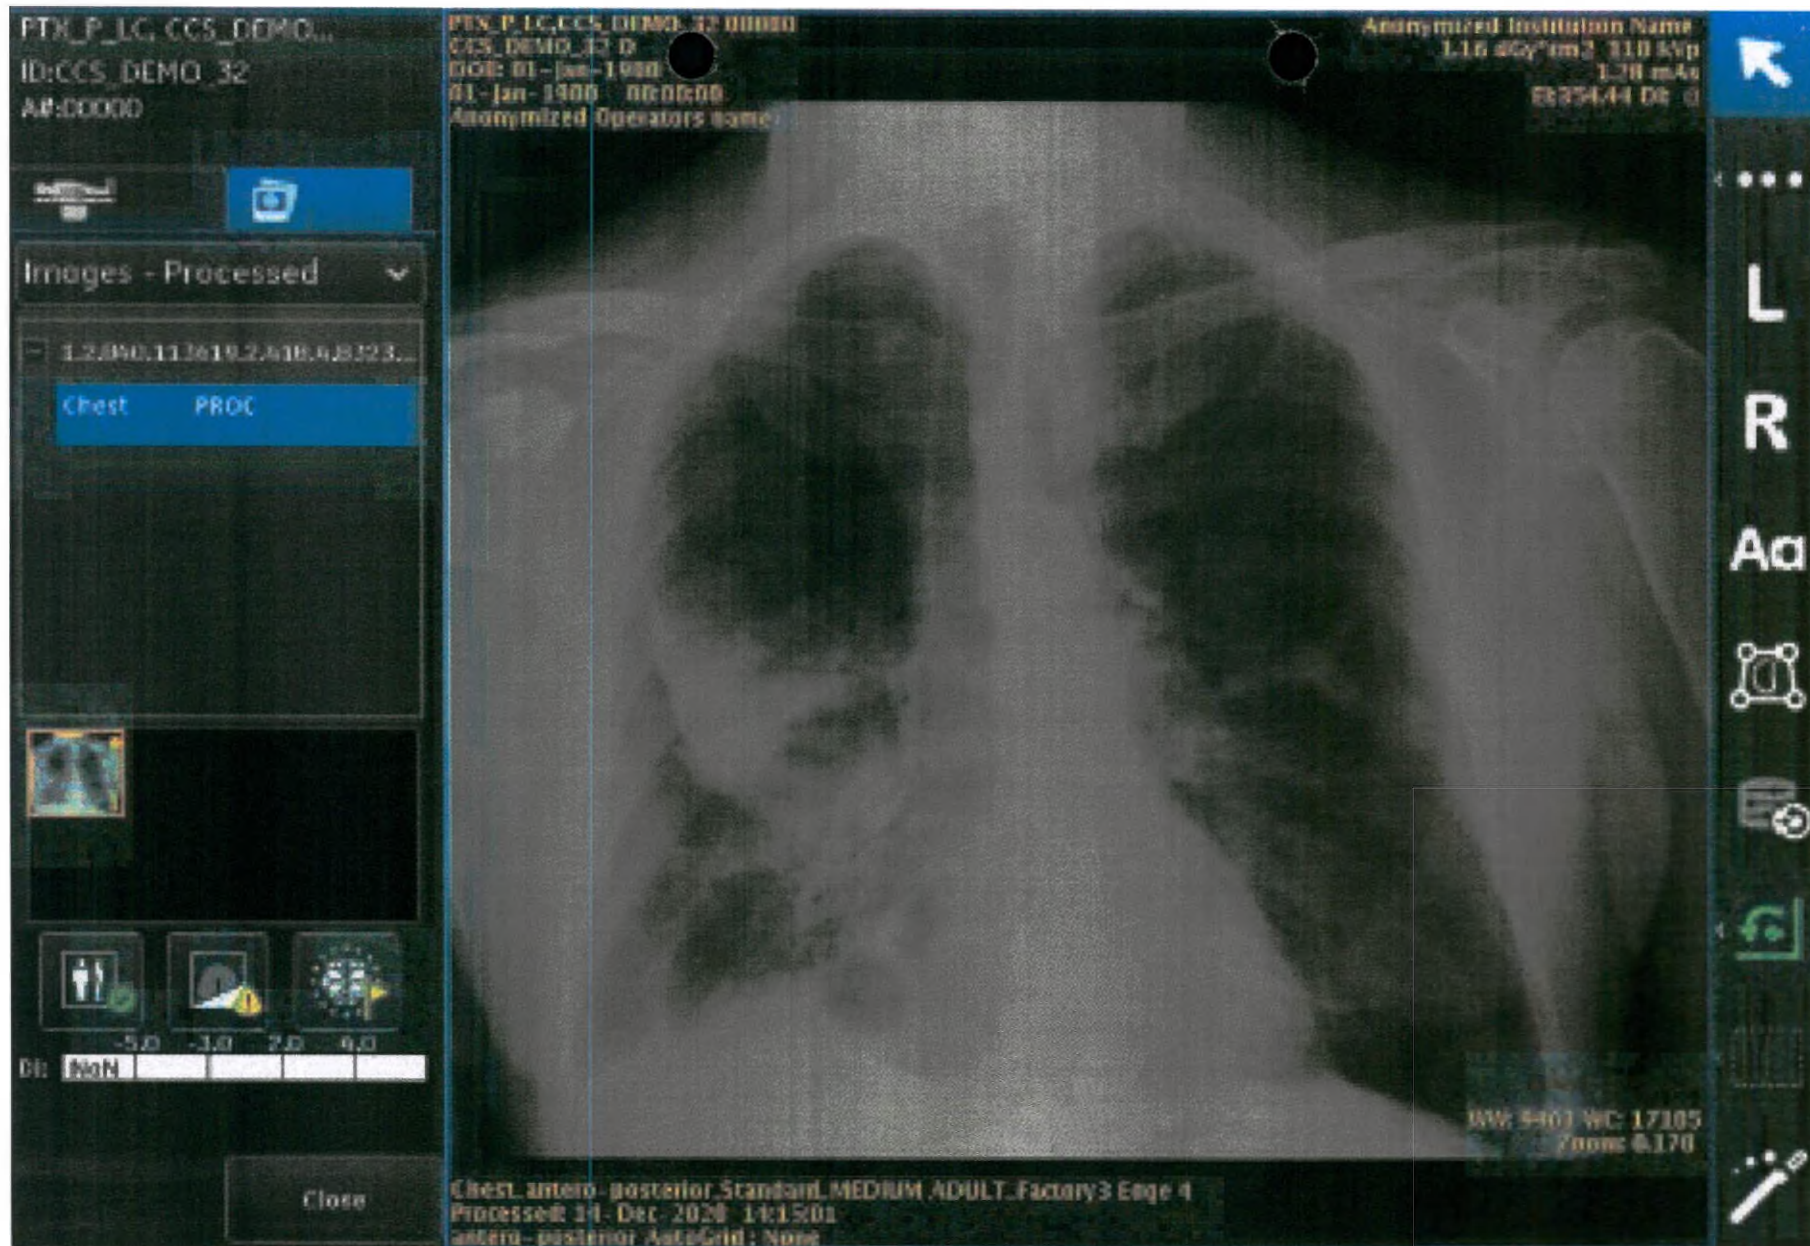


Рис. 36. Программное обеспечение «Пакет критической помощи» (Critical Care Suite) на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех

Add Exam

Enter the following information for the exam to be added to the CHEST Category

Exam Name :  ☐ Add As Default

Position Exam After :

Default Patient Size :

Exam Select Code :

Рис. 37. Программное обеспечение автоматического выбора протоколов Auto Protocol Assist на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех

Repeat/Reject Classification and Reason Entry

1. Select Operator: John Doe

2. Classify image as :

- ☐ Repeat Acquisition
- ☒ Unnecessary image (e.g. Reprocessed, VolumeRAD slices)
- ☒ Non Clinical (e.g. QC, Acceptance Tests, Calibration)

3. Select a Repeat Reason

- ☐ Patient Positioning
- ☒ Incorrect Collimation
- ☒ Patient Motion
- ☒ Patient Jewelry or Clothing
- ☒ Missing or Incorrect View Markers
- ☒ Incorrect Anatomy Selected
- ☒ Incorrect Technique Selected
- ☒ Noisy Image(s)
- ☒ Image Artifacts
- ☒ Incomplete Acquisition
- ☒ OTHER

( Max 100 chars)

☒ Apply to ALL images in series.

Save Cancel

Рис. 38. Программное обеспечение Анализ повторных/отклоненных снимков (RRA) на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех.

# AutoGrid

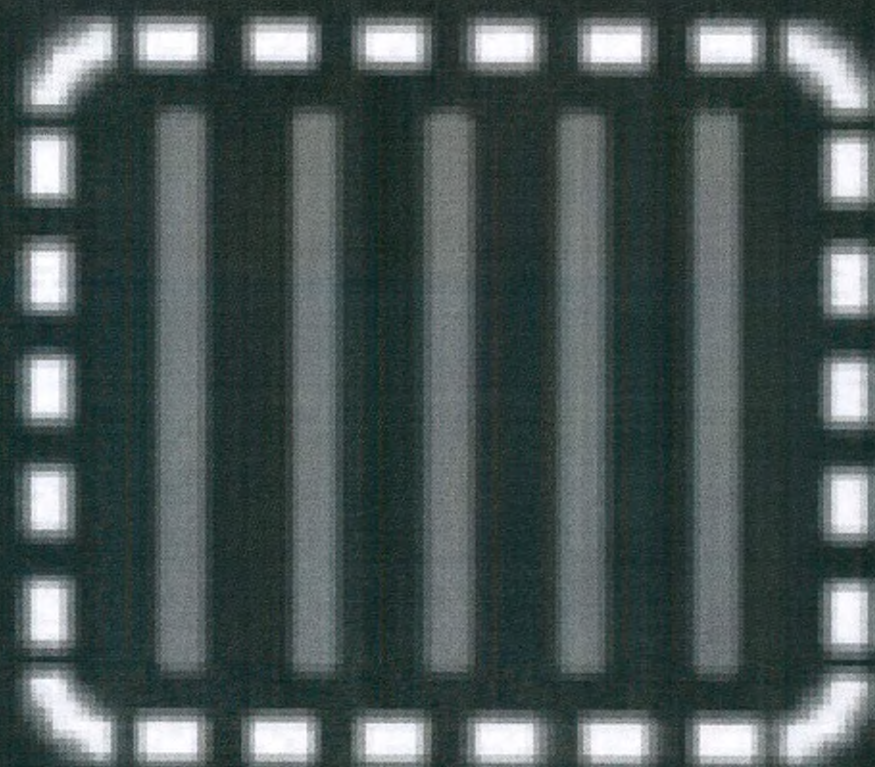


Рис. 39. Программное обеспечение для обработки изображений AutoGrid на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях



Рис. 40. Сканер штрихкодов

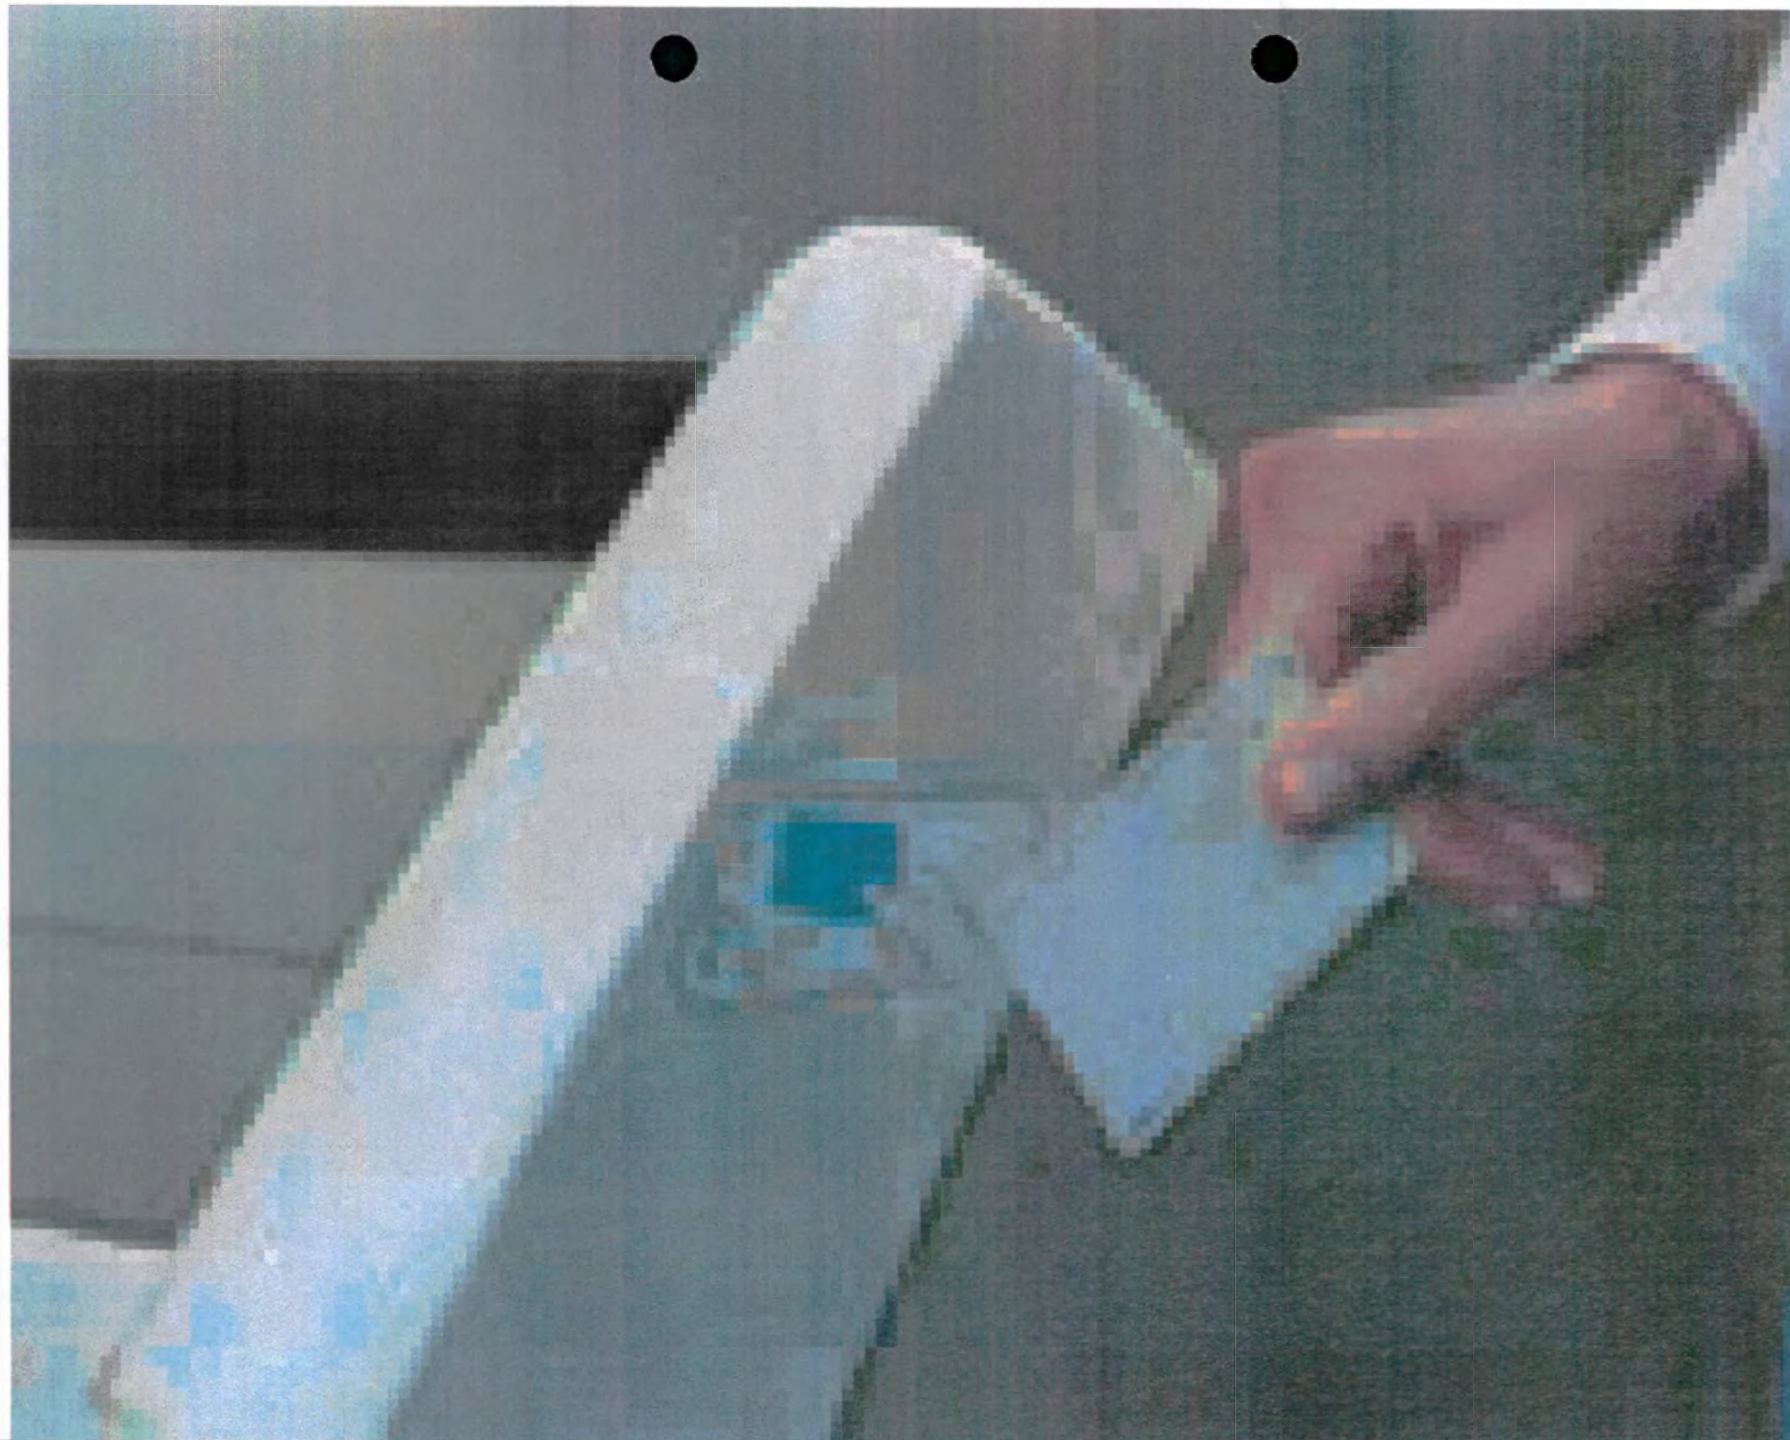


Рис. 41. Устройство считывания идентификационных карт



Рис. 42. Кабели для детектора



**Рис. 43. Компоненты для модернизации**

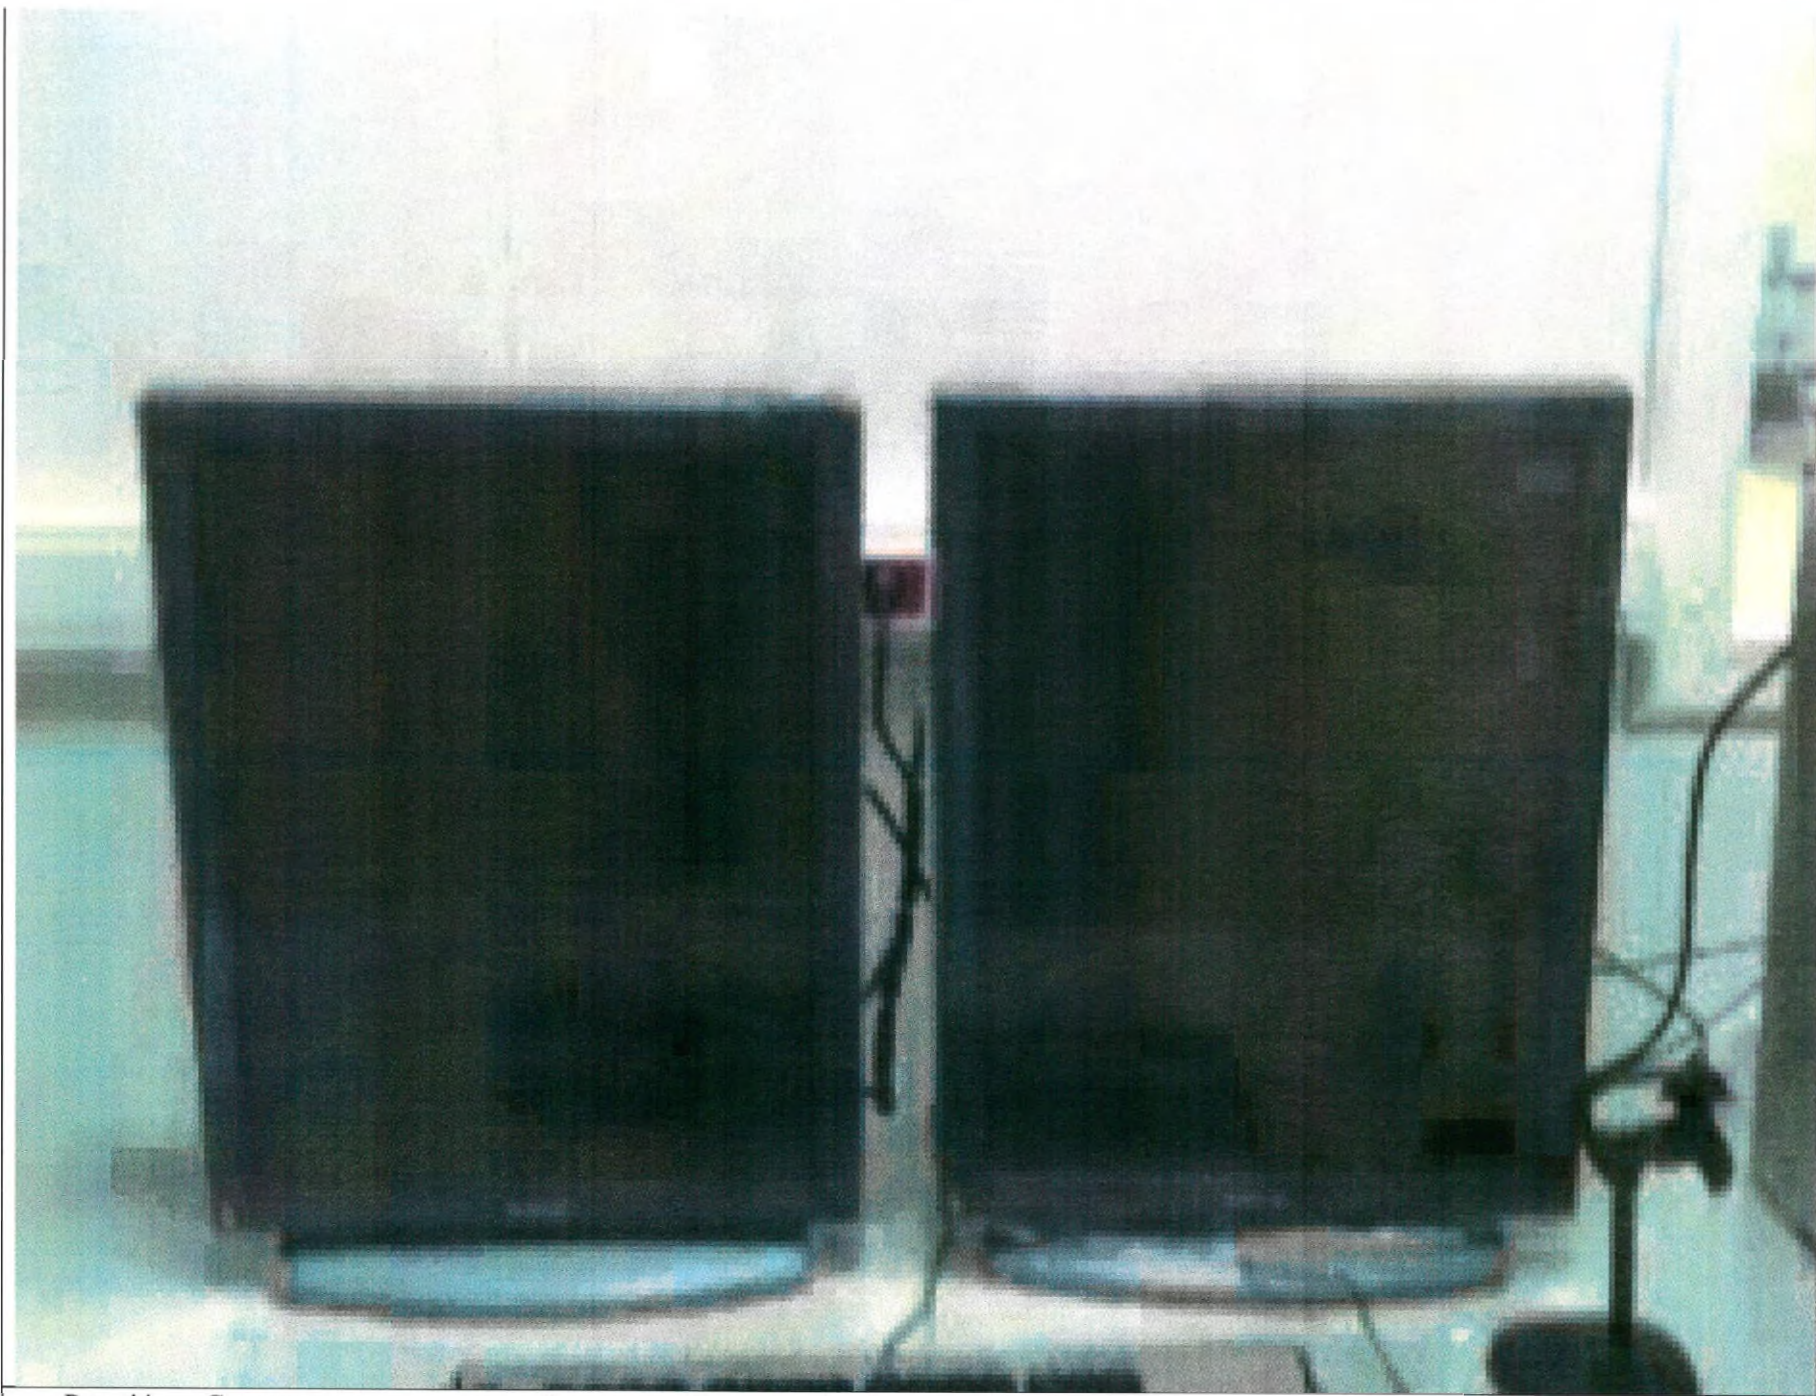


Рис. 44. Станция врача, в составе:- Компьютер; Мониторы ( не более 3 шт.);Буквенно-цифровая клавиатура; Мышь;



Рис. 45. Станция врача, в составе:- Компьютер;-Мониторы ( не более 3 шт.);Буквенно-цифровая клавиатура;-Мышь;

ACRÉE PAR L'ANRT  
Numéro d'agrément: MR 8...-RT 2014  
Date d'agrément: 29/05/2014

TRA REGISTERED No: ER65417/18  
DEALER No: DA55570/16

This telecommunication equipment  
conforms to NTC technical  
requirement.

ICASA  
TA-2014-590

Contiene Módulo CNC ID: C-15773 R-NZ

NTC  
Type Accepted  
No. ESD-CPE-1816410C

Complies With IMDA Standards  
N1578-14

ZICTA  
ZMB/ZICTA/TA/2018/8/3

OMAN-TRA  
TRA/TA-R 4744/17  
D131073

Connection and Use of this  
communications equipment is  
permitted by the Nigerian  
Communications Commission.

Model: WLE200NX  
Manufacturer: Compex Systems Pte Ltd.  
Type approval No.: TRC/SS/2016/35

Type Approval: No. 54-18120  
Name of Importer: Eldan Electronic Instruments  
Co. LTD, Israel  
Country Of Origin: China  
Manufacturer: Compex Systems PTE Ltd.

PTA  
MODEL: WLE200NX-I

CMIIT ID: 2018AJ6922(M)

IFT:RCPCOWL 18-2106

CCAG18LP0660T3

018-190110  
屋內使用限定

ANATEL  
Agência Nacional de Telecomunicações  
03234 - 19 - 11849  
Este equipamento opera em caráter  
secundário, isto é, não tem direito a  
proteção contra interferência prejudicial,  
mesmo das estações do mesmo tipo, e  
não pode causar interferência a  
sistemas operando em caráter primário.

For Aruba APIN0315:  
Product Number: IAP315-US  
Contains: FCC ID: Q9DAPIN0314315  
IC:4675A-APIN0314315  
CNC ID: C-17896

003-160046  
MSIP-CRM-ARU-APIN0315

CMIIT ID: 2016AJ6412  
IFETEL: RCPARAP16-1781

ANATEL  
04880-16-09807

ICASA  
TA-2018/2979

028

Do not use outdoors

Рис. 46. Этикеты



Рис. 47. Принтер специальный



Рис. 48. Принтер специальный



Рис. 49. Пленка для принтера



Рис. 50. Пленка для принтера

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

51 листа(ов)

