




Генеральный директор
ООО «ГОРДИЗ»
Леонов С.Н.
«16» мая 2024 г.

Фотографические изображения общего вида
Медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для обнаружения возбудителей респираторных заболеваний человека
методом анализа нуклеиновых кислот с детекцией результата методом капиллярного
электрофореза (IVD-TEST RScan) по ТУ 21.20.23-004-85818162-2020

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
для диагностики in vitro IVD-TEST Rscan
Фото 1. Набор реагентов IVD-TEST Rscan. Потребительская упаковка.

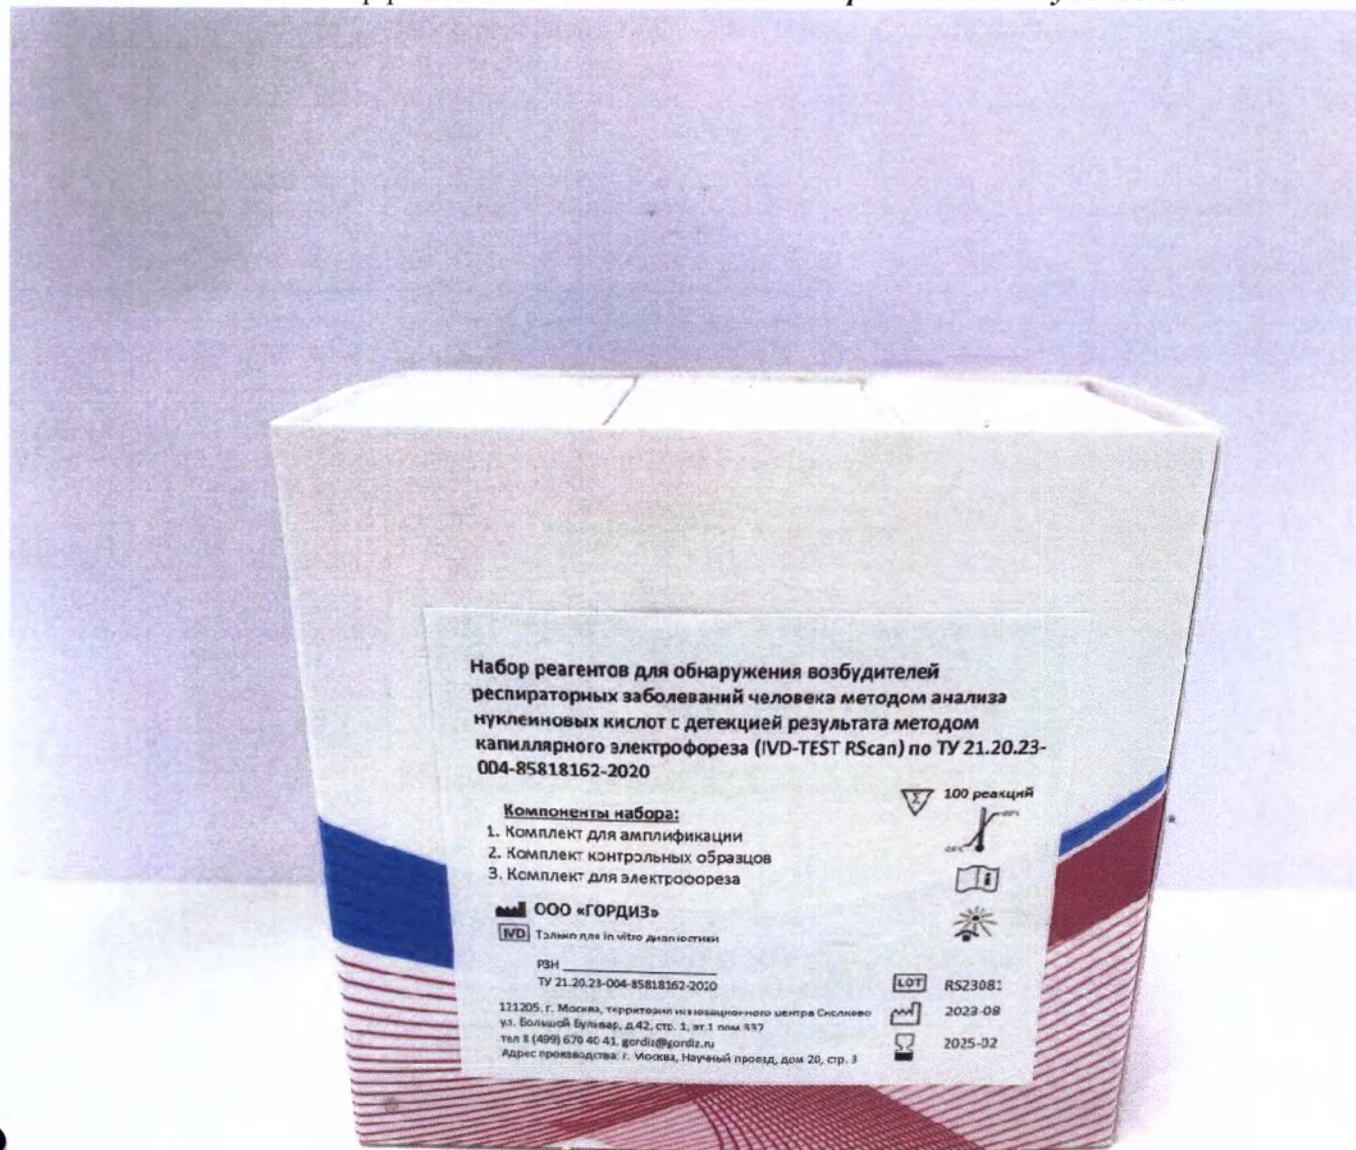

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
для диагностики in vitro IVD-TEST Rscan.

Фото 2. Набор реагентов IVD-TEST Rscan. Состав набора.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
для диагностики in vitro IVD-TEST Rscan.
Фото 3. Набор реагентов IVD-TEST Rscan. Комплект для амплификации.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
для диагностики in vitro IVD-TEST Rscan.

Фото 5. Набор реагентов IVD-TEST Rscan. Комплект контрольных образцов.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
для диагностики in vitro IVD-TEST Rscan.
Фото 7. Набор реагентов IVD-TEST Rscan. Комплект для электрофореза.



Количество страниц 6



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ГОРДИЗ»
Леонов С.Н.
«16» мая 2024 г



ООО «ГОРДИЗ»

Образцы маркировки медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для обнаружения возбудителей респираторных заболеваний человека методом анализа нуклеиновых кислот с детекцией результата методом капиллярного электрофореза (IVD-TEST RScan) по ТУ

21.20.23-004-85818162-2020

Потребительская упаковка

Набор реагентов для обнаружения возбудителей респираторных заболеваний человека методом анализа нуклеиновых кислот с детекцией результата методом капиллярного электрофореза (IVD-TEST RScan) по ТУ 21.20.23-004-85818162-2020

Компоненты набора:

1. Комплект для амплификации
2. Комплект контрольных образцов
3. Комплект для электрофореза

ООО «ГОРДИЗ»

IVD Только для in vitro диагностики

РЗН

ТУ 21.20.23-004-85818162-2020

121205, г. Москва, территория инновационного центра Сколково
ул. Большой Бульвар, д.42, стр. 1, эт.1 пом.337
тел 8 (499) 670 40 41, gordiz@gordiz.ru
Адрес производства: г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3

100 реакций



LOT RS23081

2023-08

2025-02

Комплекты реагентов

IVD-TEST RScan

Комплект контрольных образцов

Отрицательный контроль 1 пробирка, 1,7 мл
Положительный контроль 1 пробирка, 150 мкл

IVD

2025-02

LOT RS23081

-25...-20 °C

ООО «ГОРДИЗ»

IVD-TEST RScan

Комплект для электрофореза

Размерный стандарт S550 1 пробирка, 120 мкл

IVD

2025-02

LOT RS23081

-25...-20 °C

ООО «ГОРДИЗ»

IVD-TEST RScan

Комплект для амплификации

Реакционная смесь 1 пробирка, 500 мкл
Раствор активатора 1 пробирка, 500 мкл
Ревертаза 1 пробирка, 100 мкл
ОТ-контроль 1 пробирка, 100 мкл
Деионизованная вода 1 пробирка, 1,7 мл

IVD

2025-02

LOT RS23081

-25...-20 °C

ООО «ГОРДИЗ»

IVD-TEST RScan

Отрицательный Контроль

IVD

Объем 1700 мкл
Серия RS23081
Срок годности 2025-02
Хранение -25...-20 °C
Произведено ООО «ГОРДИЗ»

IVD-TEST RScan

Положительный Контроль

IVD

Объем 500 мкл
Серия RS23081
Срок годности 2025-02
Хранение -25...-20 °C
Произведено ООО «ГОРДИЗ»

IVD-TEST RScan

Размерный стандарт S550

IVD

Объем 120 мкл
Серия RS23081
Срок годности 2025-02
Хранение -25...-20 °C
Произведено ООО «ГОРДИЗ»

IVD-TEST RScan

Ревертаза

IVD

Объем 100 мкл
Серия RS23081
Срок годности 2025-02
Хранение -25...-20 °C
Произведено ООО «ГОРДИЗ»

IVD-TEST RScan

Реакционная Смесь

IVD

Объем 500 мкл
Серия RS23081
Срок годности 2025-02
Хранение -25...-20 °C
Произведено ООО «ГОРДИЗ»

IVD-TEST RScan

Раствор Активатора

IVD

Объем 500 мкл
Серия RS23081
Срок годности 2025-02
Хранение -25...-20 °C
Произведено ООО «ГОРДИЗ»

IVD-TEST RScan

ОТ-контроль

IVD

Объем 100 мкл
Серия RS23081
Срок годности 2025-02
Хранение -25...-20 °C
Произведено ООО «ГОРДИЗ»

IVD-TEST RScan

Деионизованная вода

IVD

Объем 1700 мкл
Серия RS23081
Срок годности 2025-02
Хранение -25...-20 °C
Произведено ООО «ГОРДИЗ»