

Согласовано

ООО «ЦИСЗ»

Организация

127473, город Москва, улица Селезневская, д. 11А, стр.
2, эт/ком/оф 2/30,32/232

Адрес

Генеральный директор

Должность

Ширшов К.Г..

Фамилия, Имя

«02» июля 2024 года

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись




Фотографические изображения

Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики в вариантах исполнения

2024

Рис. 2. Катетер баллонный дилатационный Shupmei для коронарной ангиопластики РТСА Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 5 мм

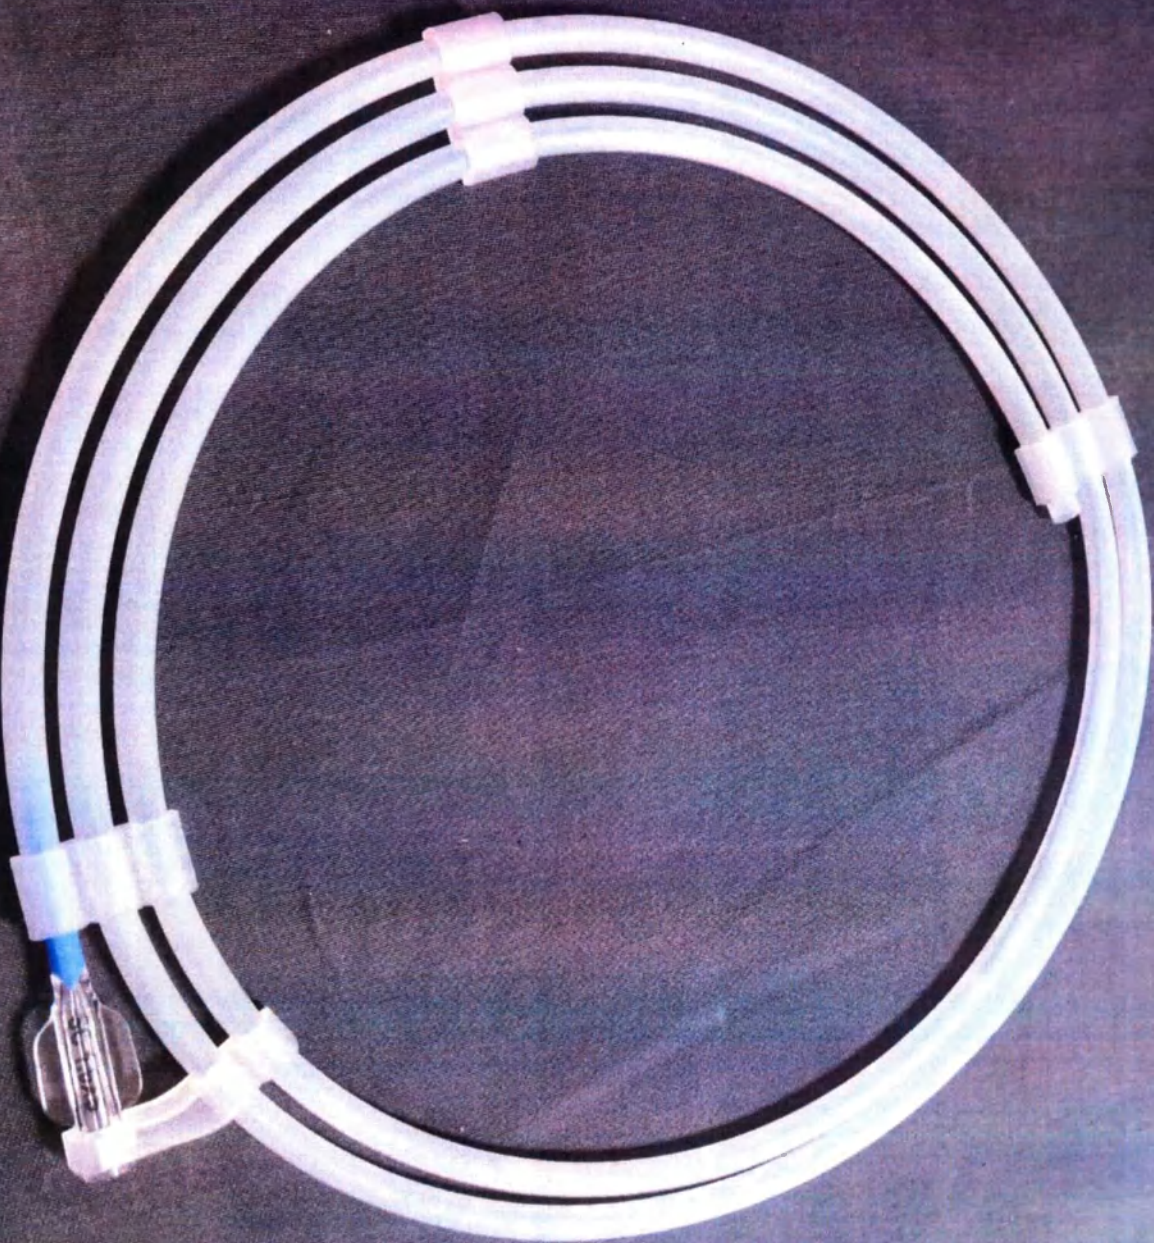

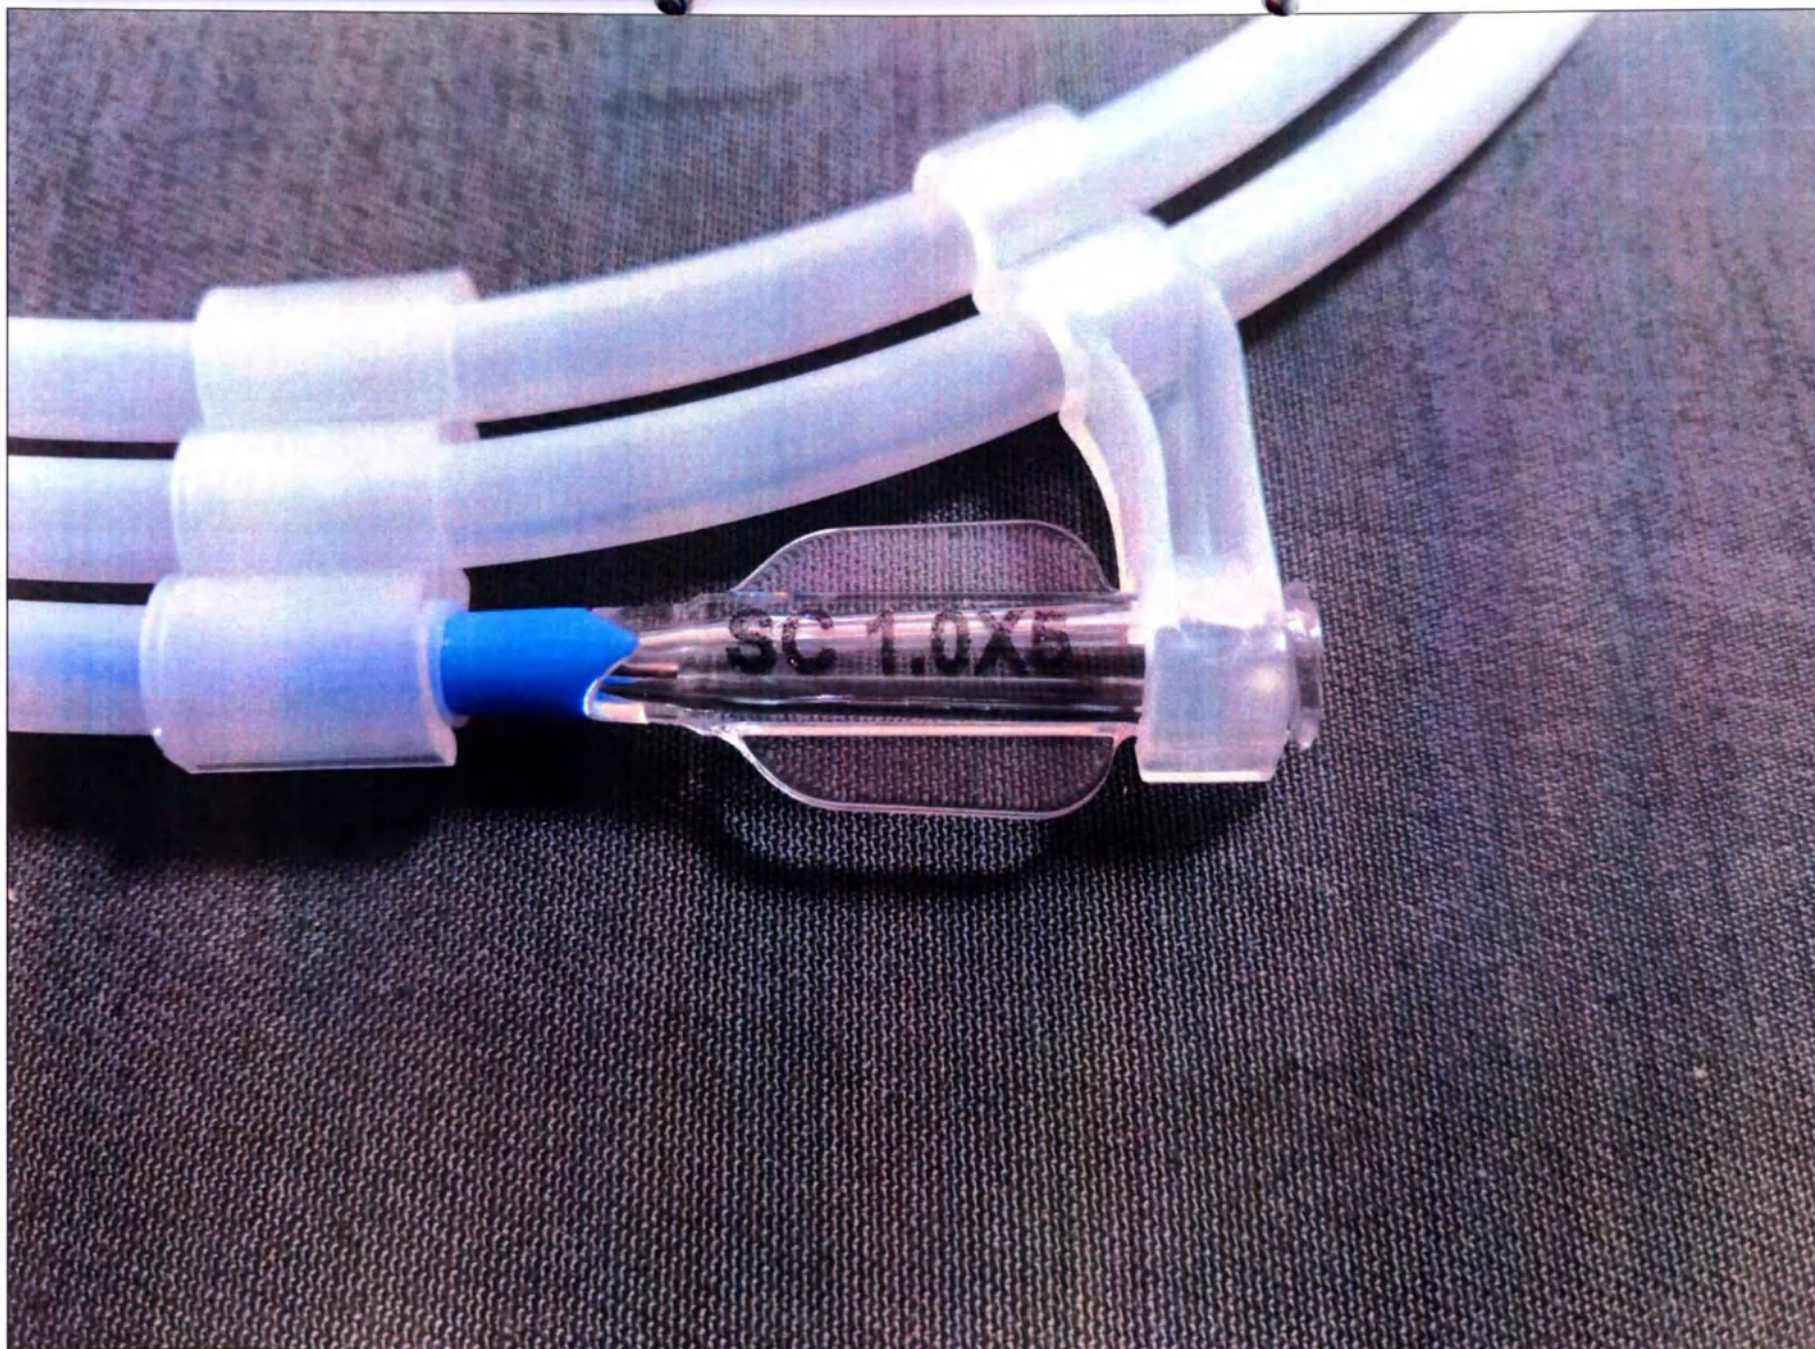


Рис. 3. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 5 мм



Рис. 4. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 5 мм

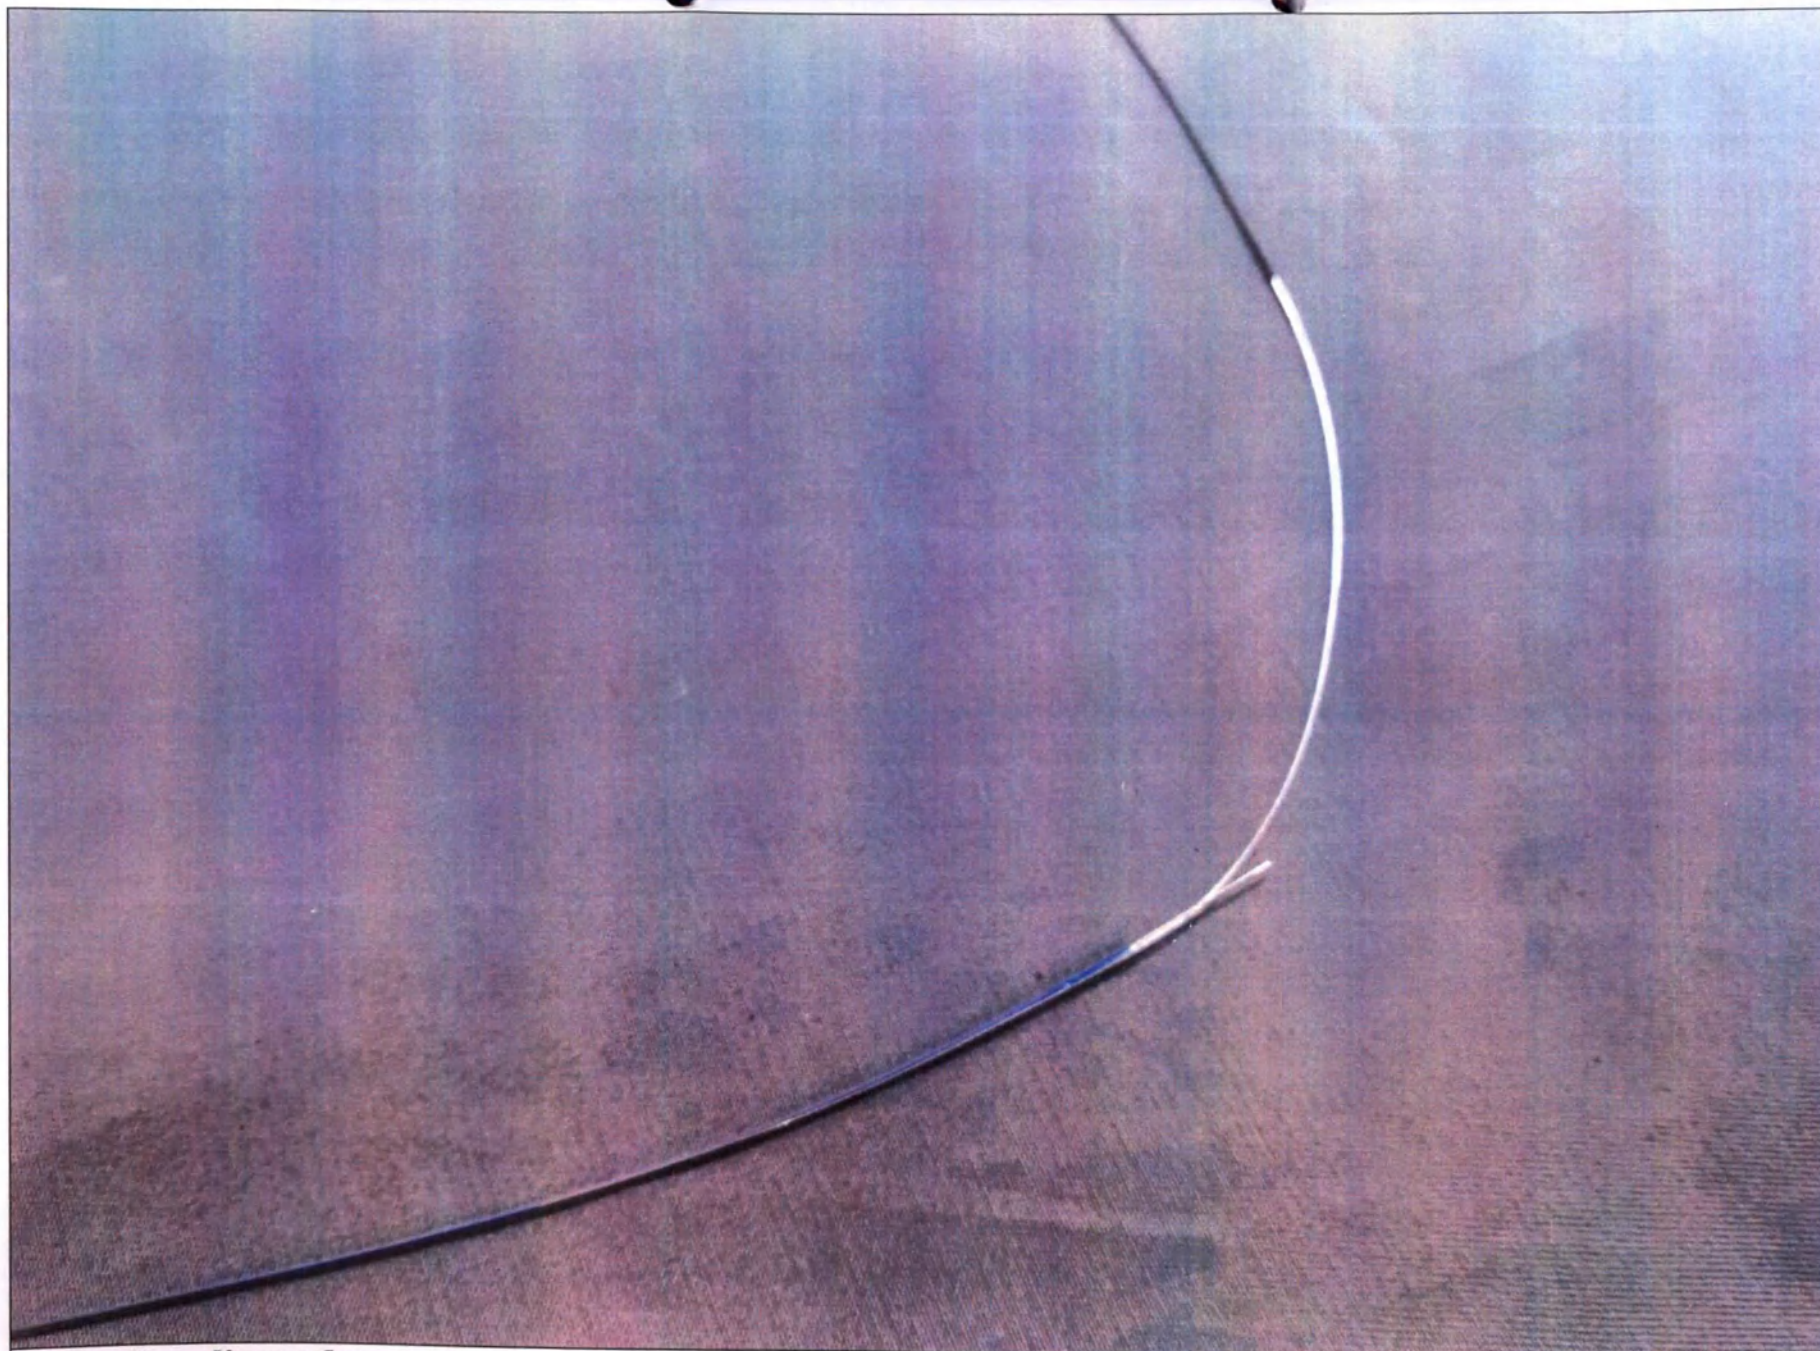


Рис. 5. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 5 мм

Shunmei
Medical technology creates future

RX 4.0x30
mm mm



PTCA
Shun Loach

Shunmei®
Balloon Dilatation Catheter

RX *Semi-Compliance*


Coronary Dilatation Catheter; Cathéter de dilatation coronaire; Coronaire-dilatatiekatheter; Katheter für die Koronardilatation; Koronardilatationskatheter; Catetere per dilatazione coronarica; Catéter de dilatación coronaria; Cateter de dilatação coronária; Κορητικός διαστολής στεφανώσιδος αρτηρίας; Cewnik do poszerzania światła naczyń wieńcowych; Koronární dilatační katétr; 관상동맥확장 카테터; 冠狀動脈擴張導管; 冠狀動脈擴張導管

 202311
 202610
 2311016L



$\geq 5Fr$
0.057" (1.42mm)

⊙ 4.0mm

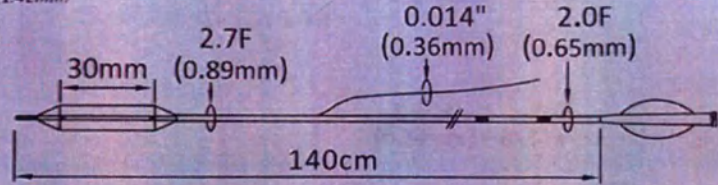

BALLOON ϕ 4.0mm
 BALLOON 30mm
 REF 642810
 LOT 2311016L
 202311
 202610

Pressure		Balloon Diameter (mm)
ATM	KPa	
2	203	3.77
4	405	3.89
6	608	4.00
8	810	4.11
10	1013	4.23
12	1216	4.34
14	1418	4.45
16 (RBP)	1621	4.57
18	1823	4.68

Do not exceed the rated burst pressure (RBP).

Shunmei Medical Co., Ltd
Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
 No.8 of 1st Jinlong road, Baolong Industrial Zone,
 LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory:
 Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
 Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
 Tel: +0086-0752-3306949
 Email: nora@shunmei.com
 Web: www.shunmei.com

EC REP Lotus NL B.V.
 Koninigin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
 The Hague, Netherlands.
 Tel: +31644168999
 Email: peter@lotusnl.com
 made in China
 File No.: SM-LB-PTCA(BDC)-001
 Version: A.5 Effective date: 2021.05.10

CE
 2690

CE
2696

PTCA Balloon 4.0mm×30mm

(01)06956014426108

(17)202610(10)2311016L

REF 642810 LOT 2311016L

PTCA Balloon 4.0mm×30mm

(01)06856014428108

(17)202610(10)2311016L

REF 642810 LOT 2311016L

PTCA
Shun Loach

4.0 × 30
mm mm

RX *Semi-Compliance*


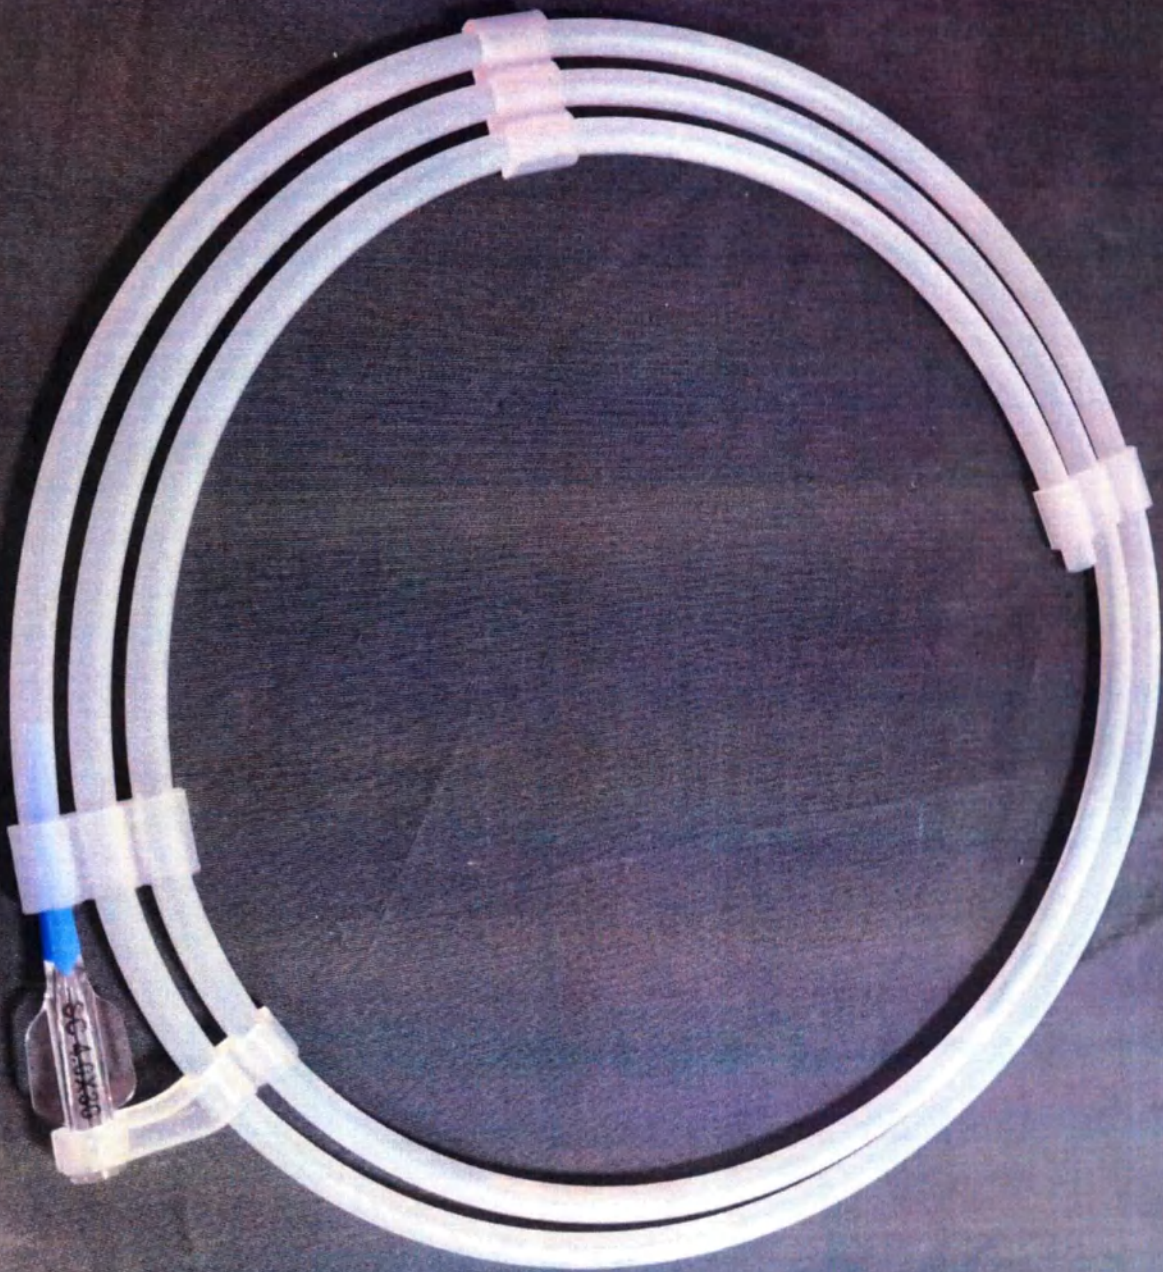


Рис. 6. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм

Рис. 7. Катетер баллонный дилатационный Shuntel для коронарной ангиопластики РТСА Shunt Loach, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм



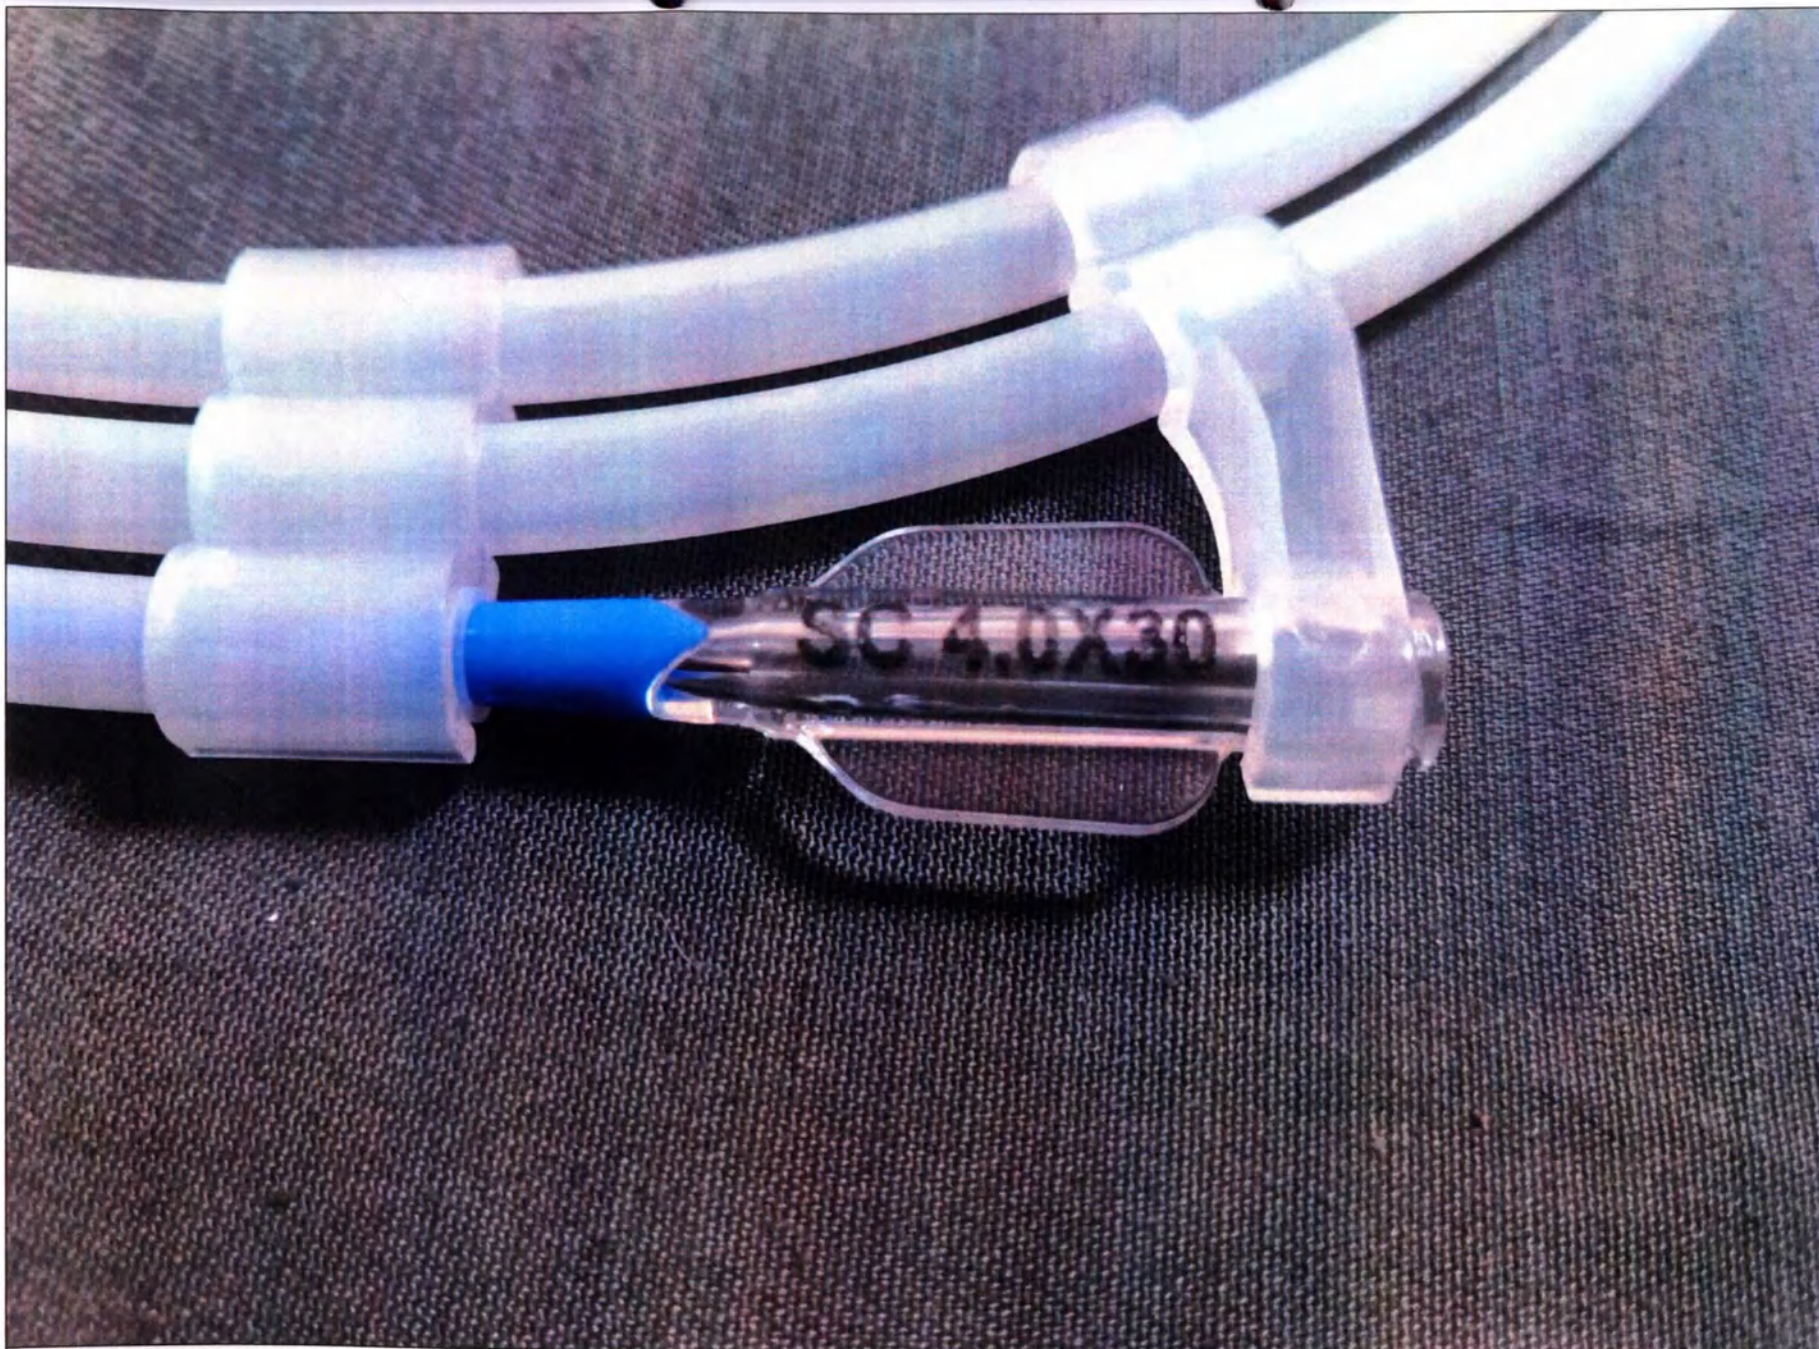


Рис. 8. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм

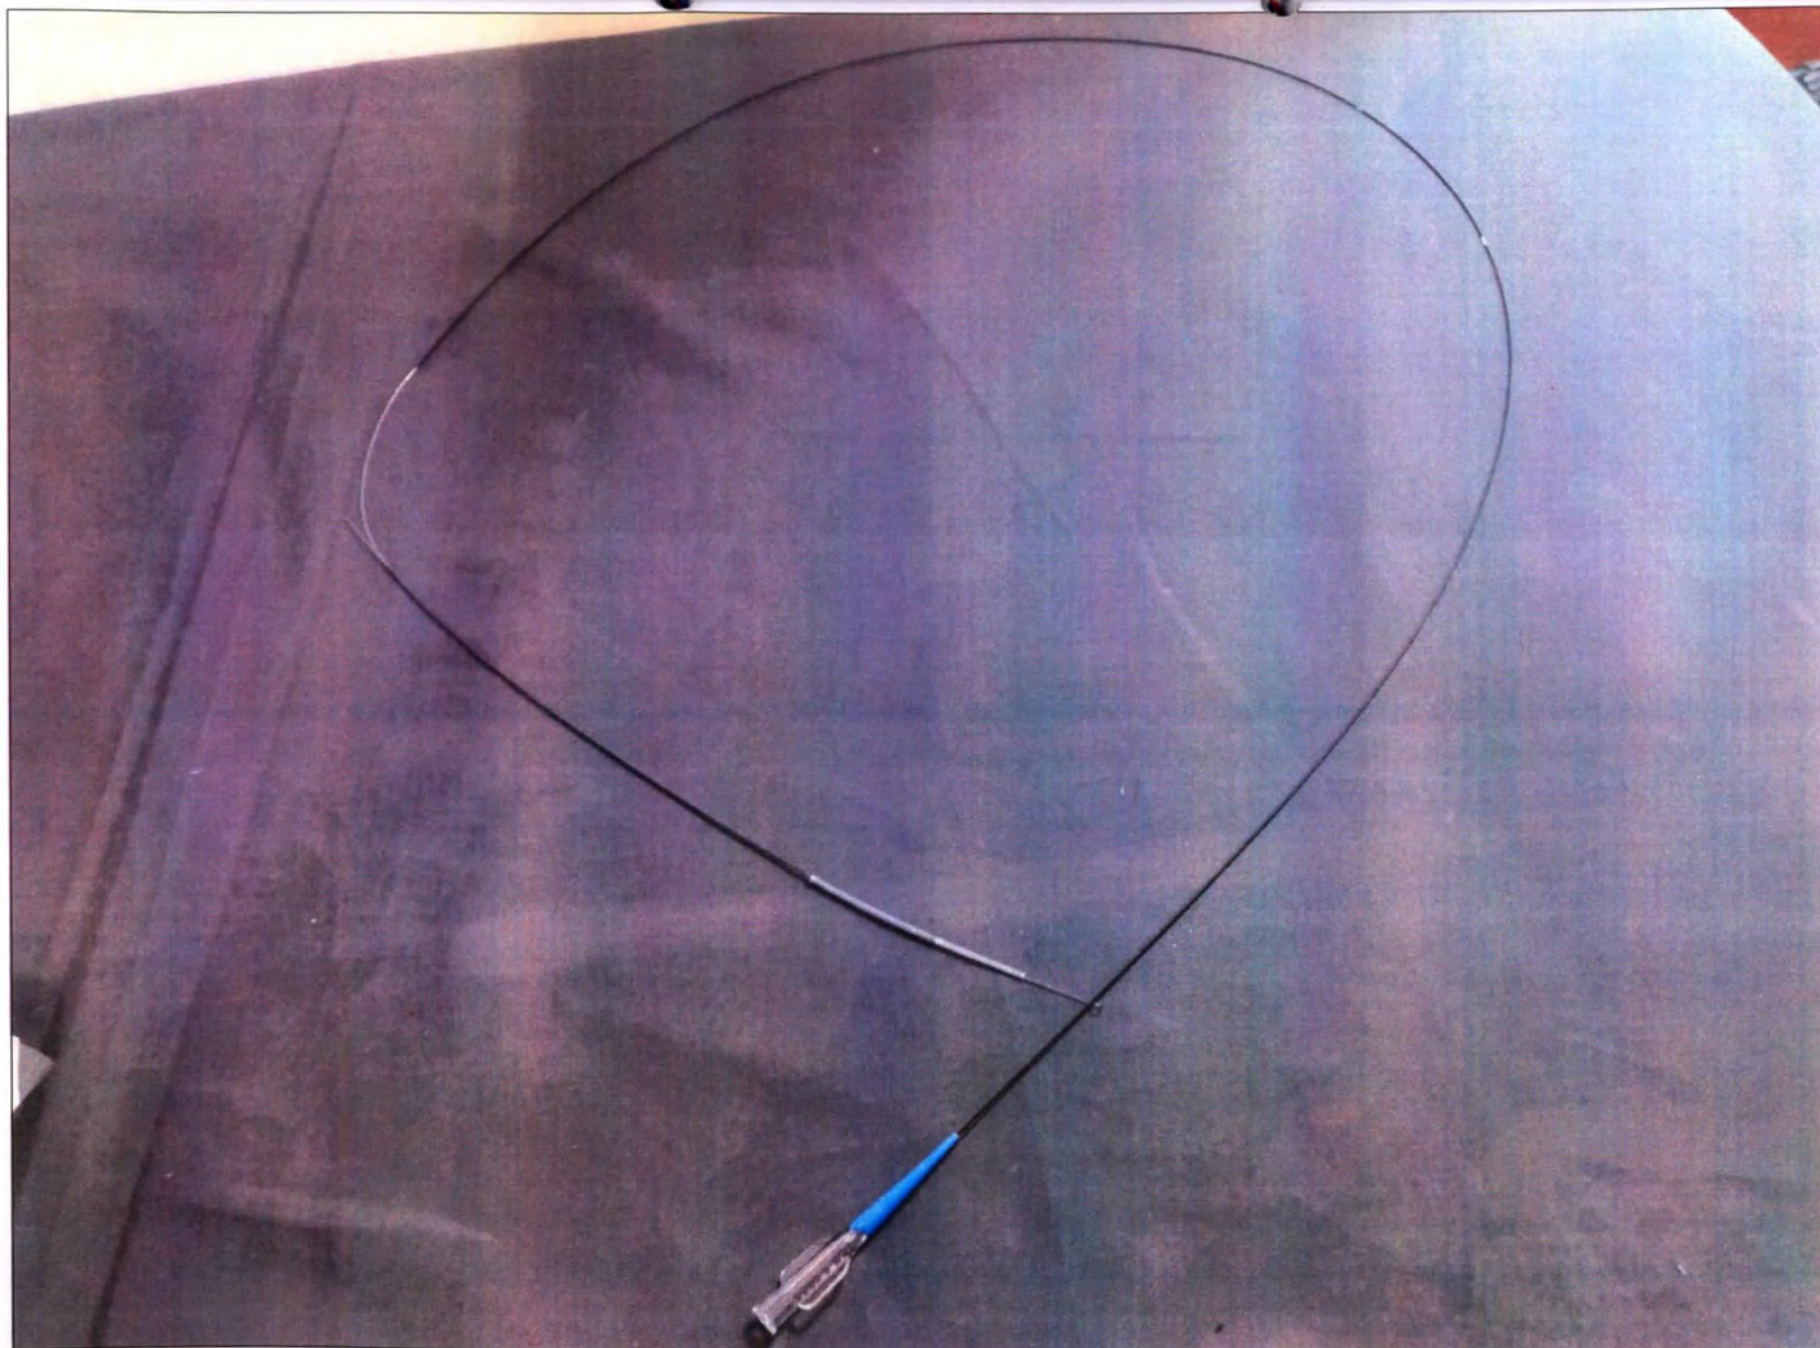


Рис. 9. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм

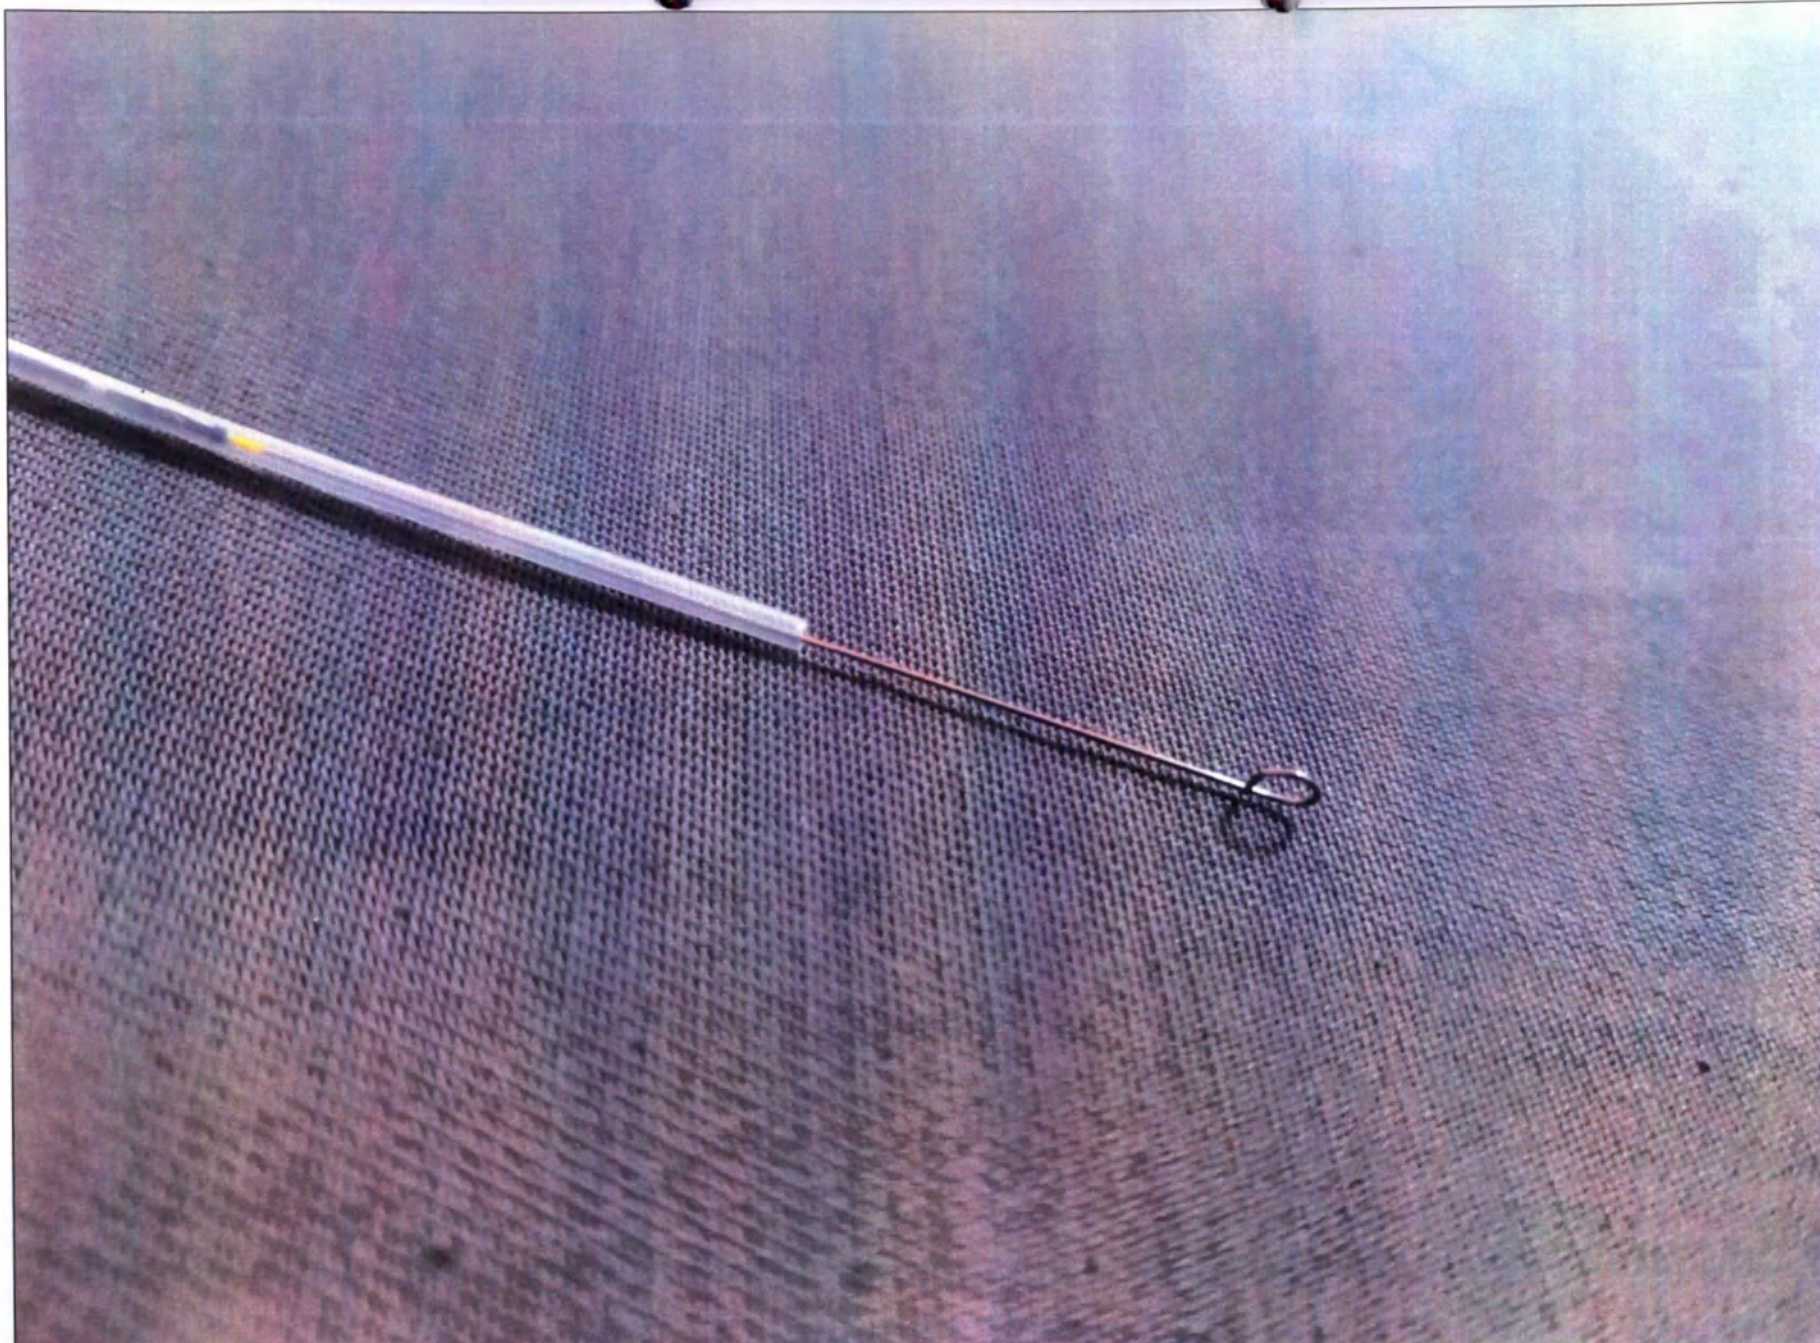


Рис. 10. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм

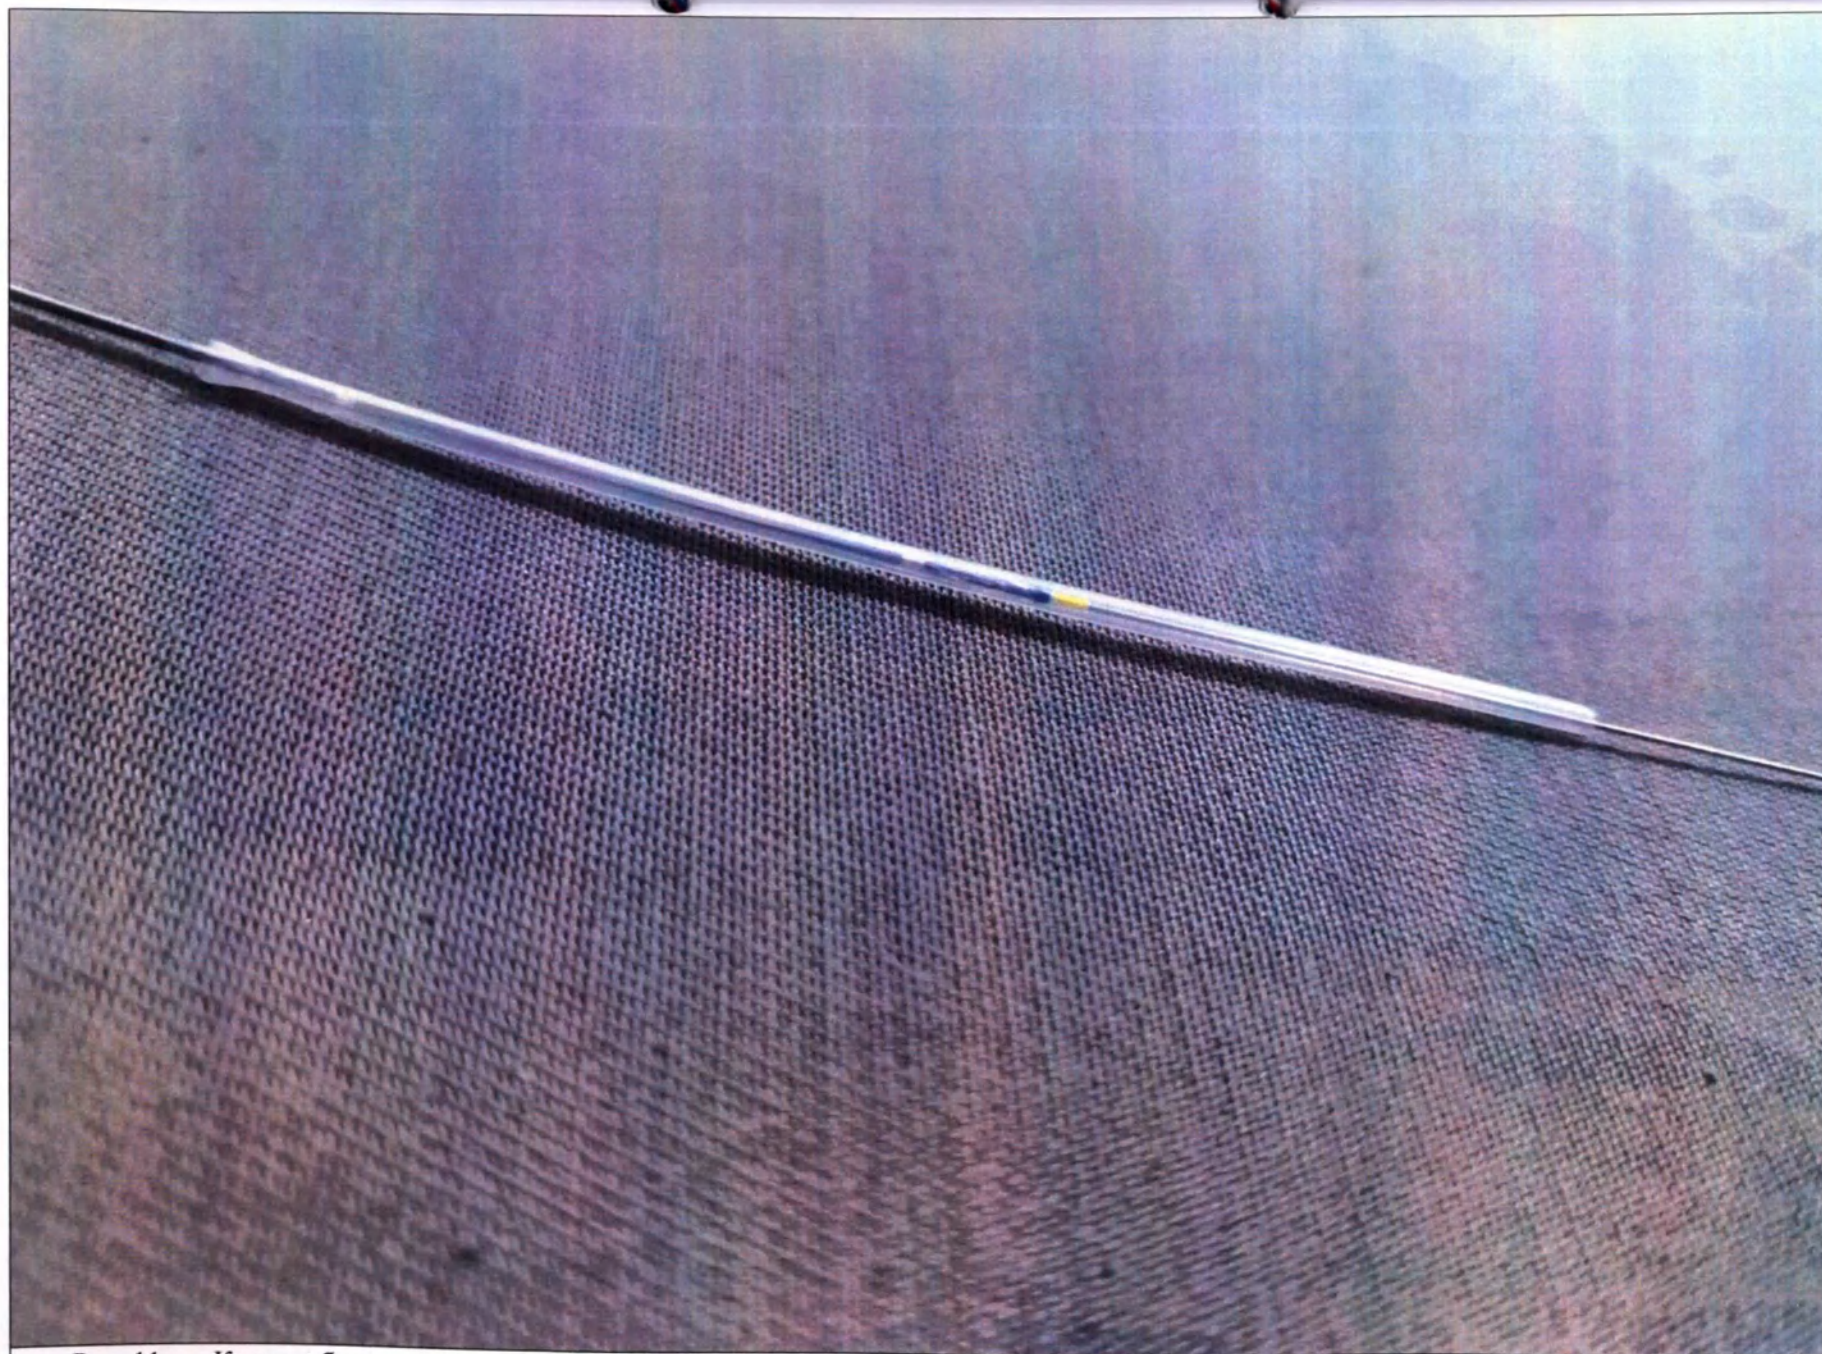


Рис. 11. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм

Shunmei
Medical technology creates future

RX 2.0x6
mm mm



Shunmei


RX Non-Compliance

Balloon Dilatation Catheter

Coronary Dilatation Catheter; Cathéter de dilatation coronaire; Coronaire-dilatatiekatheter; Katheter für die Koronardilatation; Koronardilatationskatheter; Catetere per dilatazione coronarica; Catéter de dilatación coronaria; Cateter de dilatação coronária; Κορωνοειδής διαστολικός στεφανιαίος αρτηρίας; Cewnik do poszerzania światła naczyń wieńcowych; Koronární dilatální katétr; 관상동맥확장 카테터; 冠状動脈擴張導管; 冠状动脉扩张导管

$\rho \geq 5Fr$
0.057" (1.42mm)

2.0mm

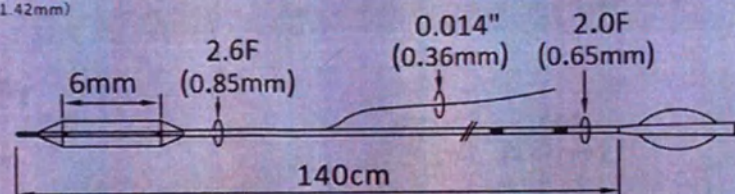

NC Loach

202311
202610
LOT 2311016L



BALLOON ϕ 2.0mm
BALLOON 6mm
REF 643802
LOT 2311016L
202311
202610

Pressure		Balloon Diameter (mm)
ATM	KPa	
6	608	1.94
8	810	1.96
10	1013	1.98
12 (RBP)	1216	2.00
14	1418	2.02
16	1621	2.04
18	1823	2.06
20	2026	2.08
22 (RBP)	2229	2.10
24	2431	2.12
26	2634	2.14

Do not exceed the rated burst pressure (RBP).

Shunmei Medical Co., Ltd

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China

Factory:
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd. 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China
File No.: 5M-LB-NC(CDC)-001
Version: A.5 Effective date: 2021.05.10

CE
2696

NC Balloon 2.0mmx6mm




REF 643802 LOT 2311016L

NC Balloon 2.0mmx6mm



REF 643802 LOT 2311016L



NC Loach 2.0 x 6
mm mm

RX Non-Compliance

Рис. 12. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 6 мм

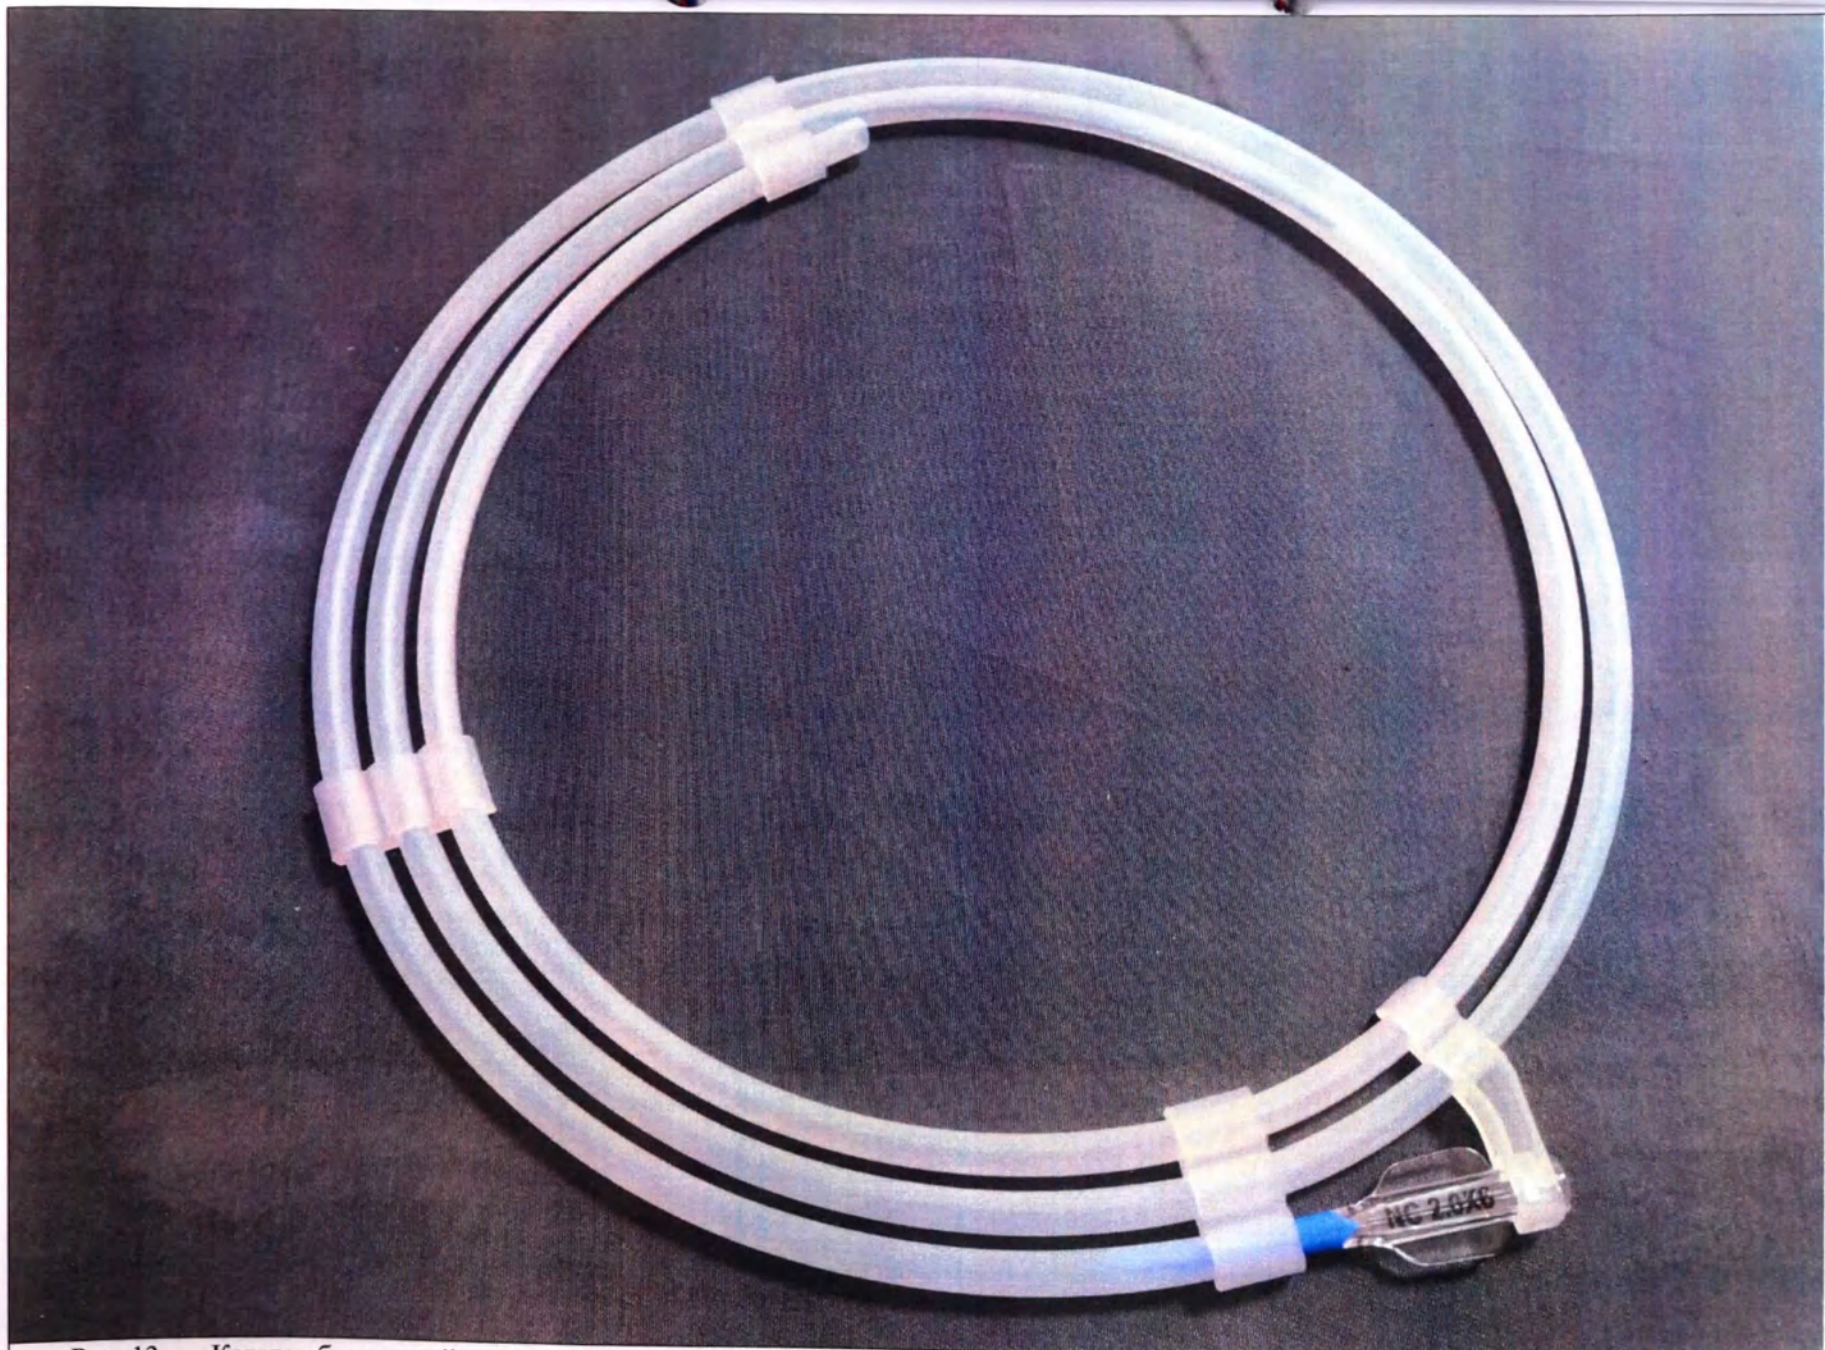


Рис. 13. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 6 мм

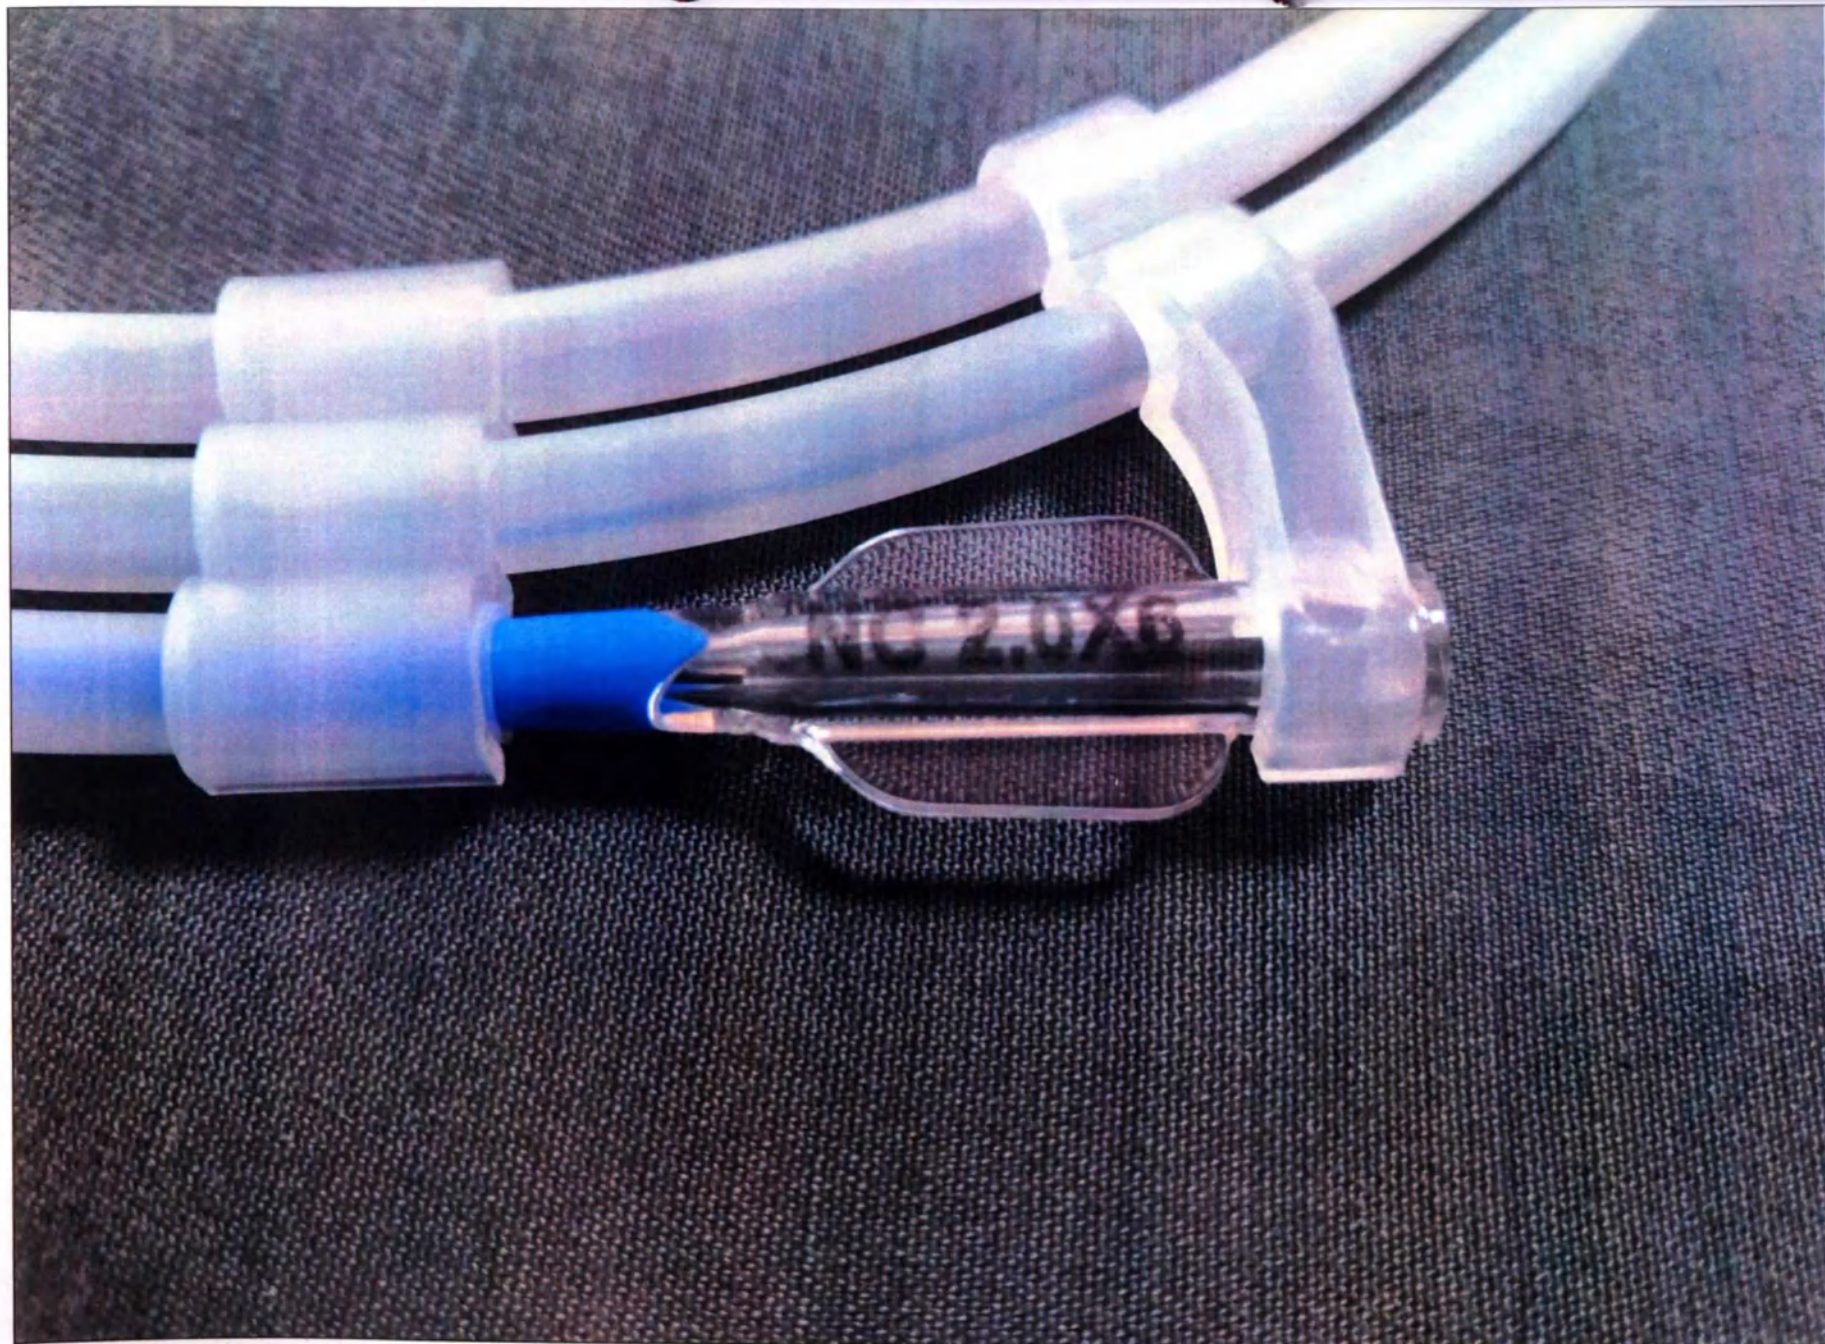


Рис. 14. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 6 мм

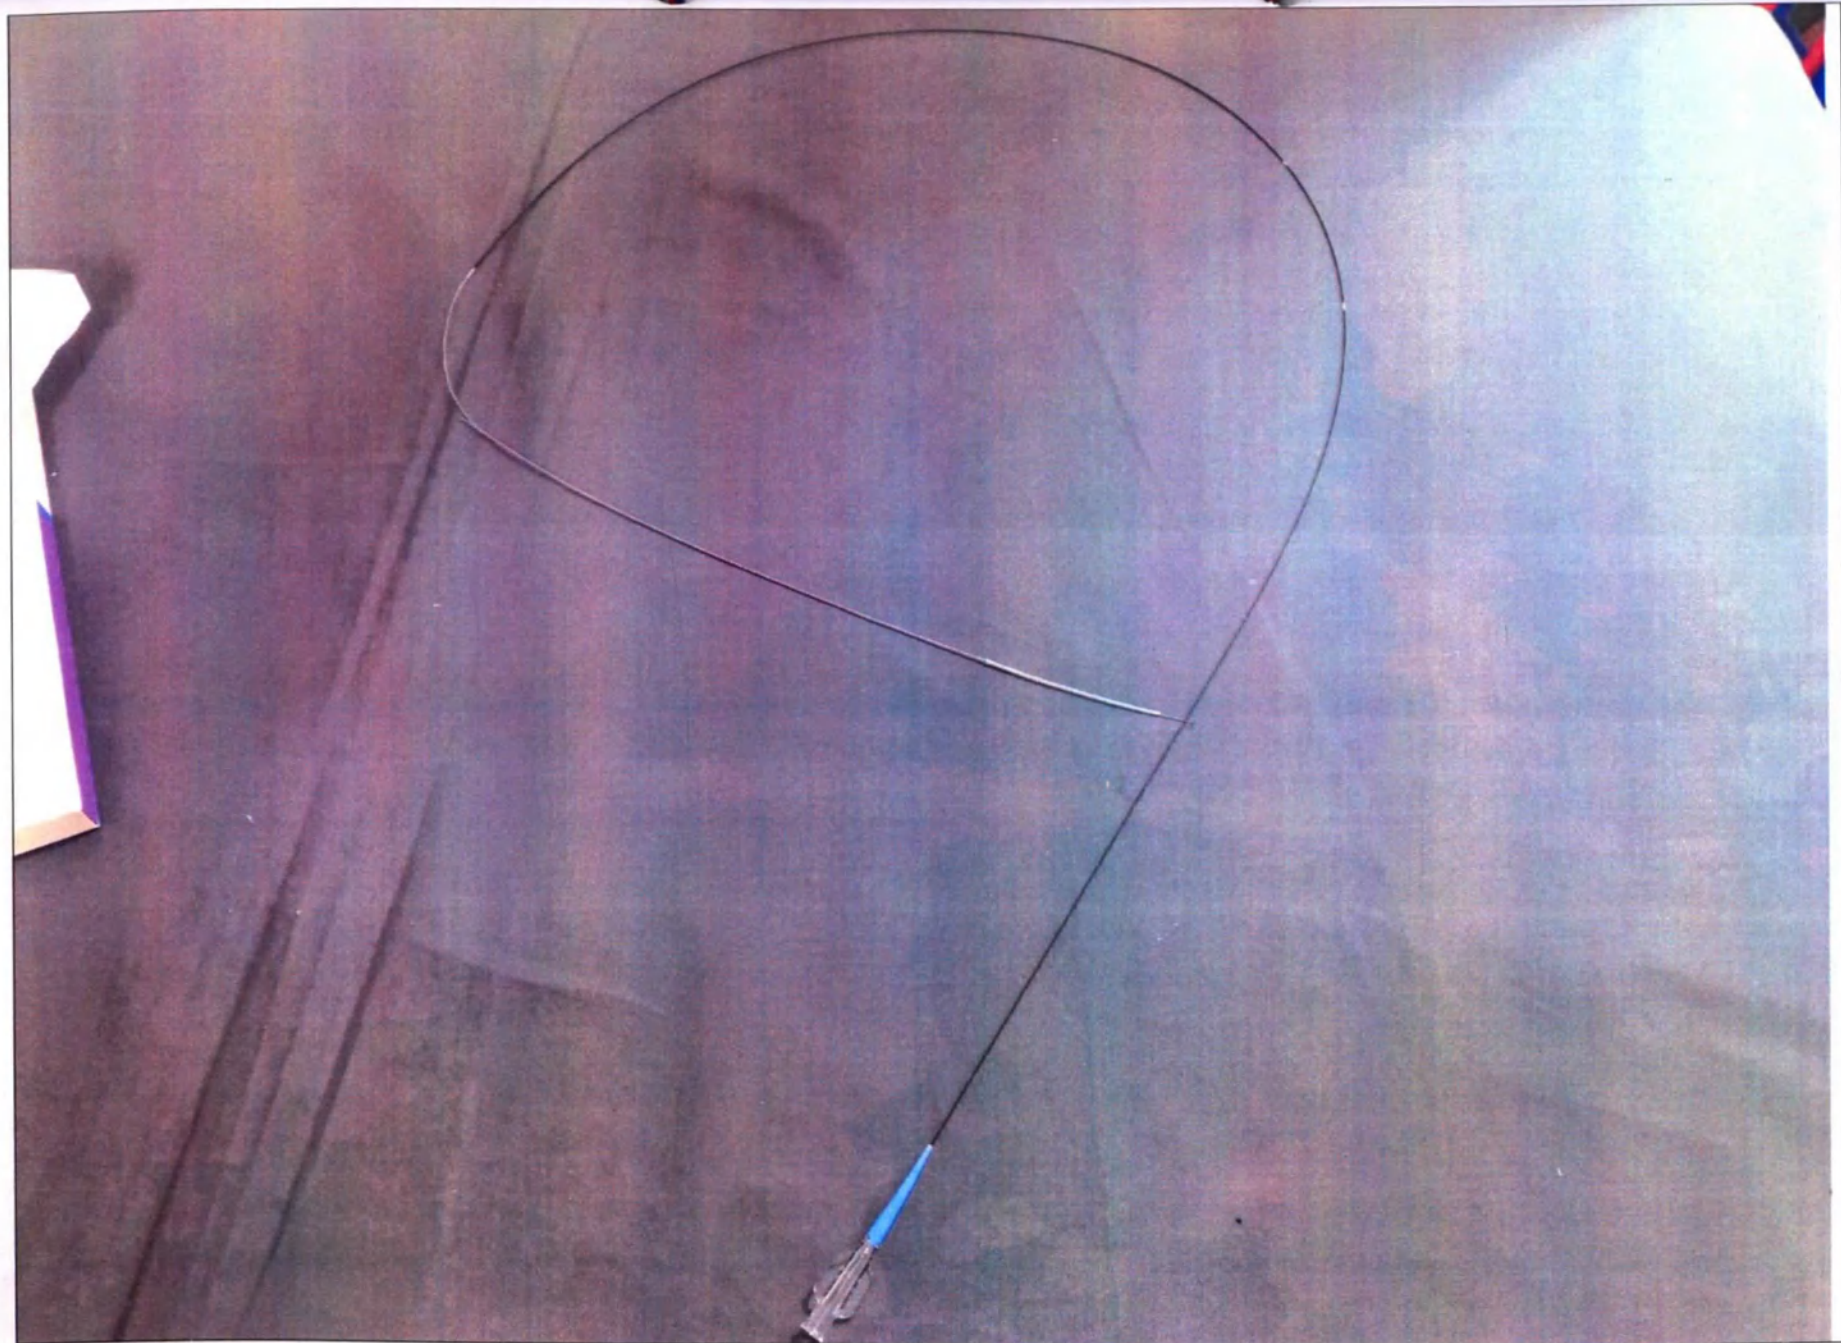


Рис. 15. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 6 мм

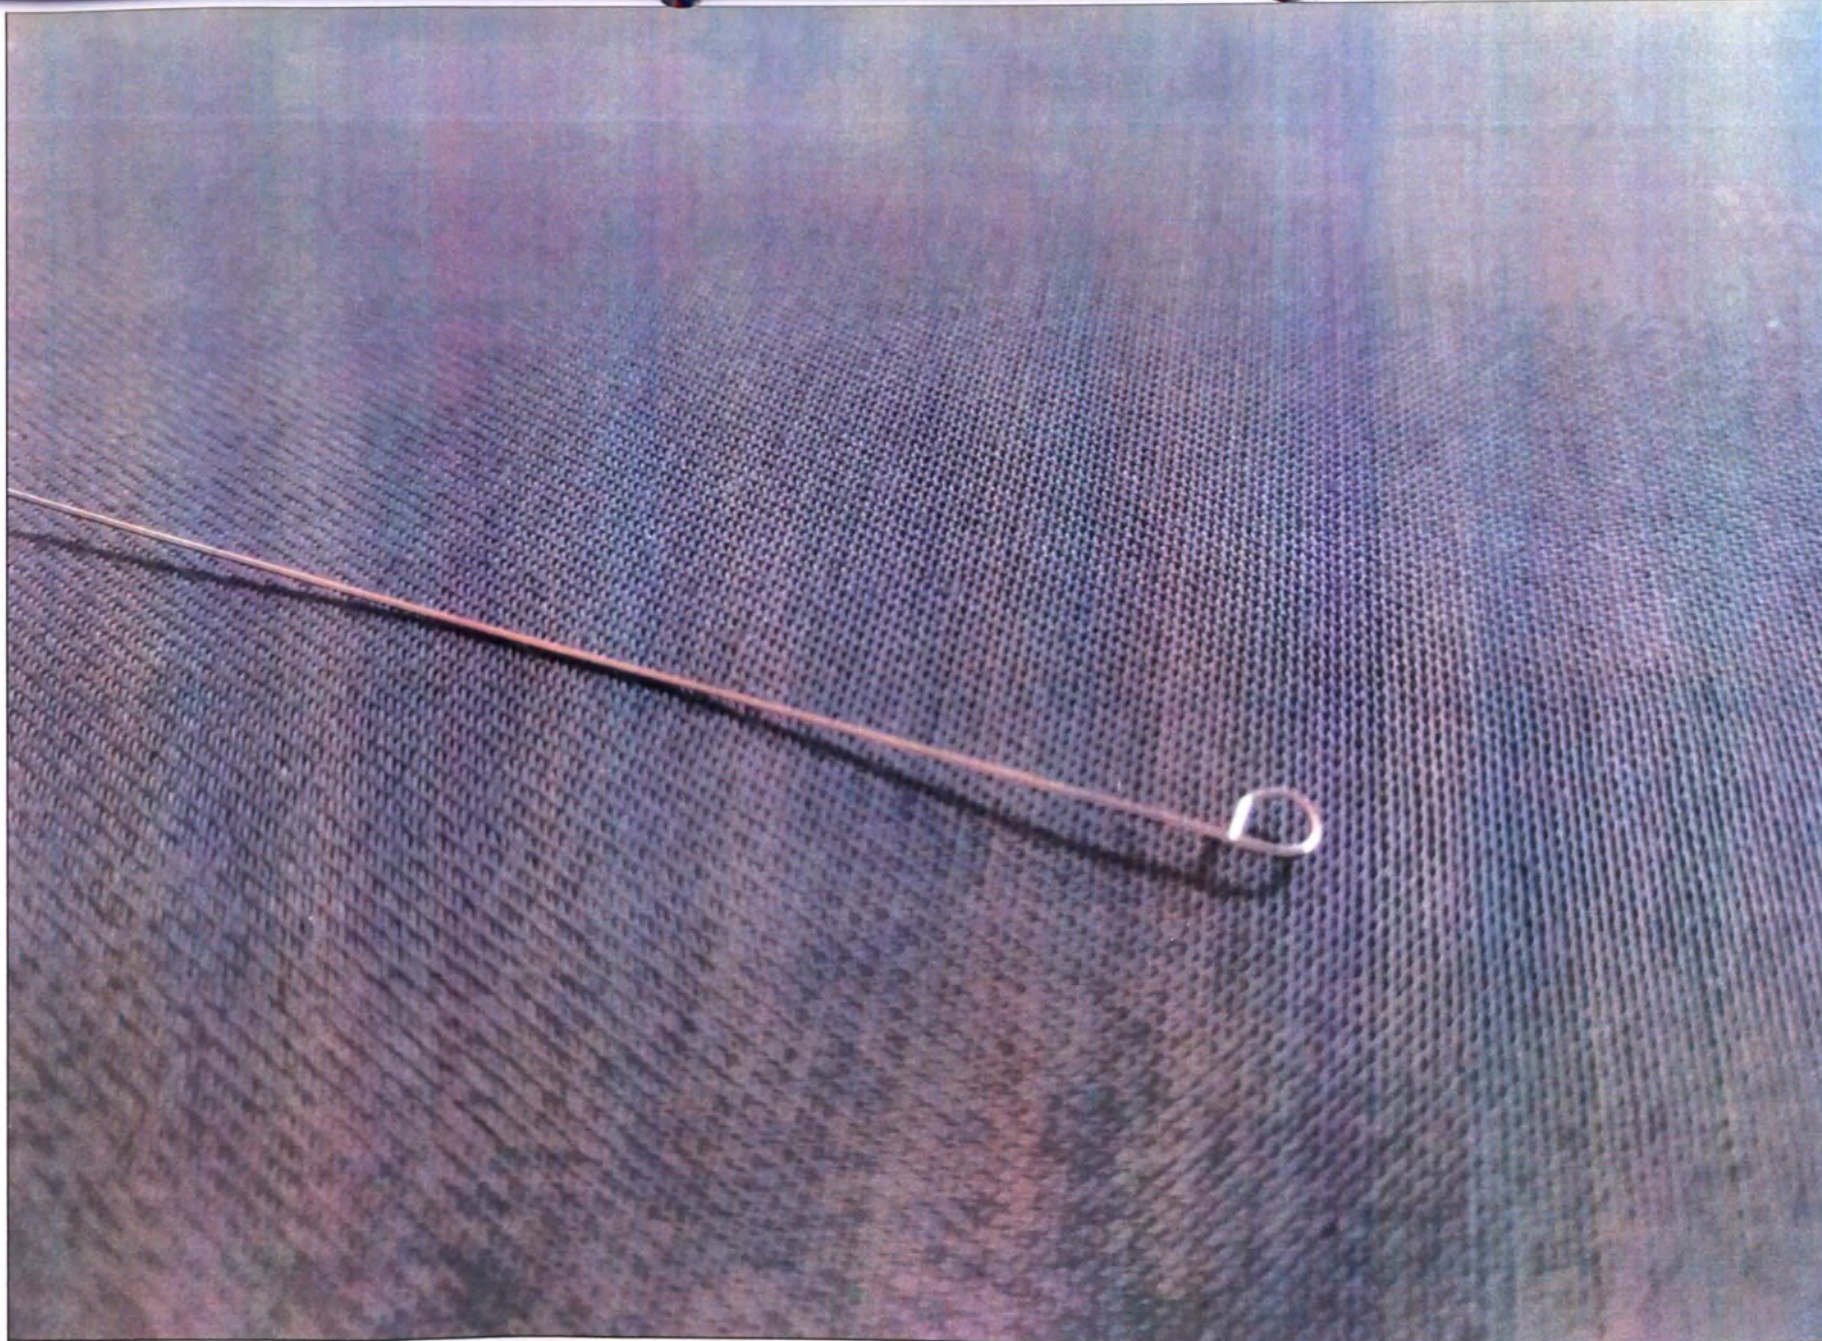


Рис. 16. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 6 мм

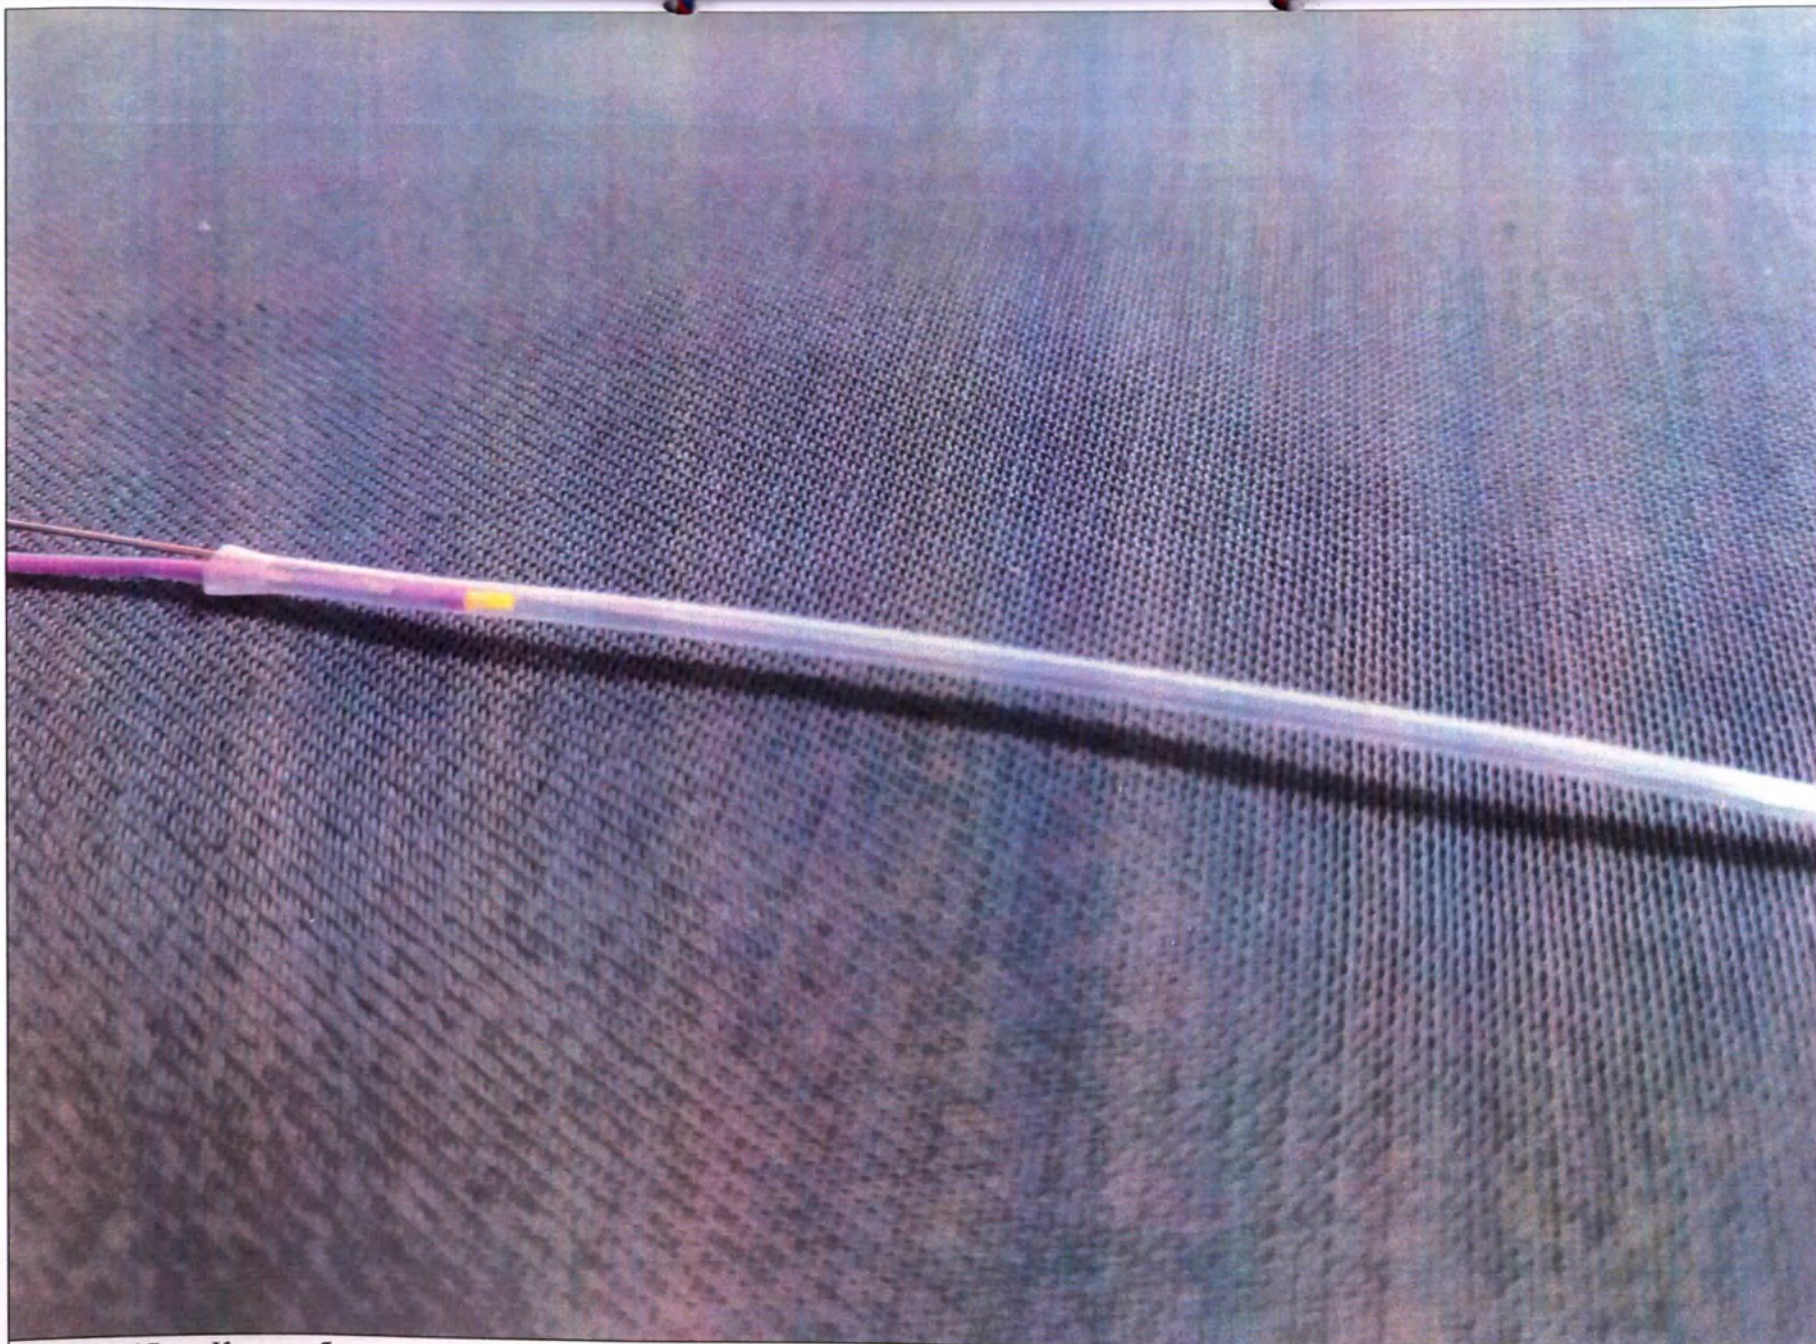


Рис. 17. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 6 мм

Shunmei
Medical technology creates future

RX 5.0x20
mm mm



(01)06956014439074
(17)202610(10)2311016L


Shunmei
Balloon Dilatation Catheter

RX Non-Compliance

Coronary Dilatation Catheter; Cathéter de dilatation coronaire; Coronaire-dilatatiekatheter; Kathier für die Koronardilatation;
Koronardilatationskatheter; Catetere per dilatazione coronarica; Catéter de dilatación coronaria; Cateter de dilatação coronária;
Καθετήρας διαστολής στεφανιαίας αρτηρίας; Cewnik do poszerzania światła naczyń wieńcowych; Koronární dilatační katétr;
관상동맥확장 카테터; 冠狀動脈擴張導管; 冠狀动脉扩张导管

$\rho \geq 5Fr$
0.057" (1.42mm)

ϕ 5.0mm

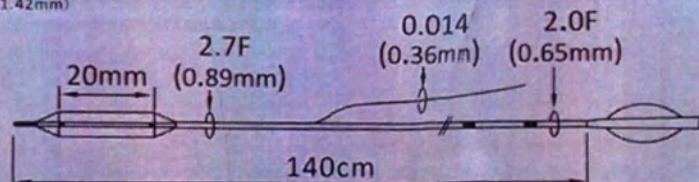

Pressure		Balloon Diameter (mm)
ATM	KPa	
6	608	4.76
8	810	4.84
10	1013	4.92
12	1216	5.00
14	1418	5.08
16	1621	5.16
18	1823	5.24
20 (RBP)	2026	5.31
22	2229	5.39
24	2431	5.47
26	2634	5.55

Do not exceed the rated burst pressure (RBP).

Shunmei Medical Co., Ltd
Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No. 8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory:
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com
EC REP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China
File No.: SM-LB-NC(CDC)-001
Version: A.5 Effective date: 2021.05.10

CE
2696

NC Loach

202311
202610
LOT 2311016L



ϕ 5.0mm
20mm
REF 643907
LOT 2311016L
202311
202610

NC Balloon 5.0mmx20mm




REF 643907 LOT 2311016L

NC Balloon 5.0mmx20mm



REF 643907 LOT 2311016L



NC Loach 5.0 x 20
mm mm

RX Non-Compliance

Рис. 18. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 20 мм

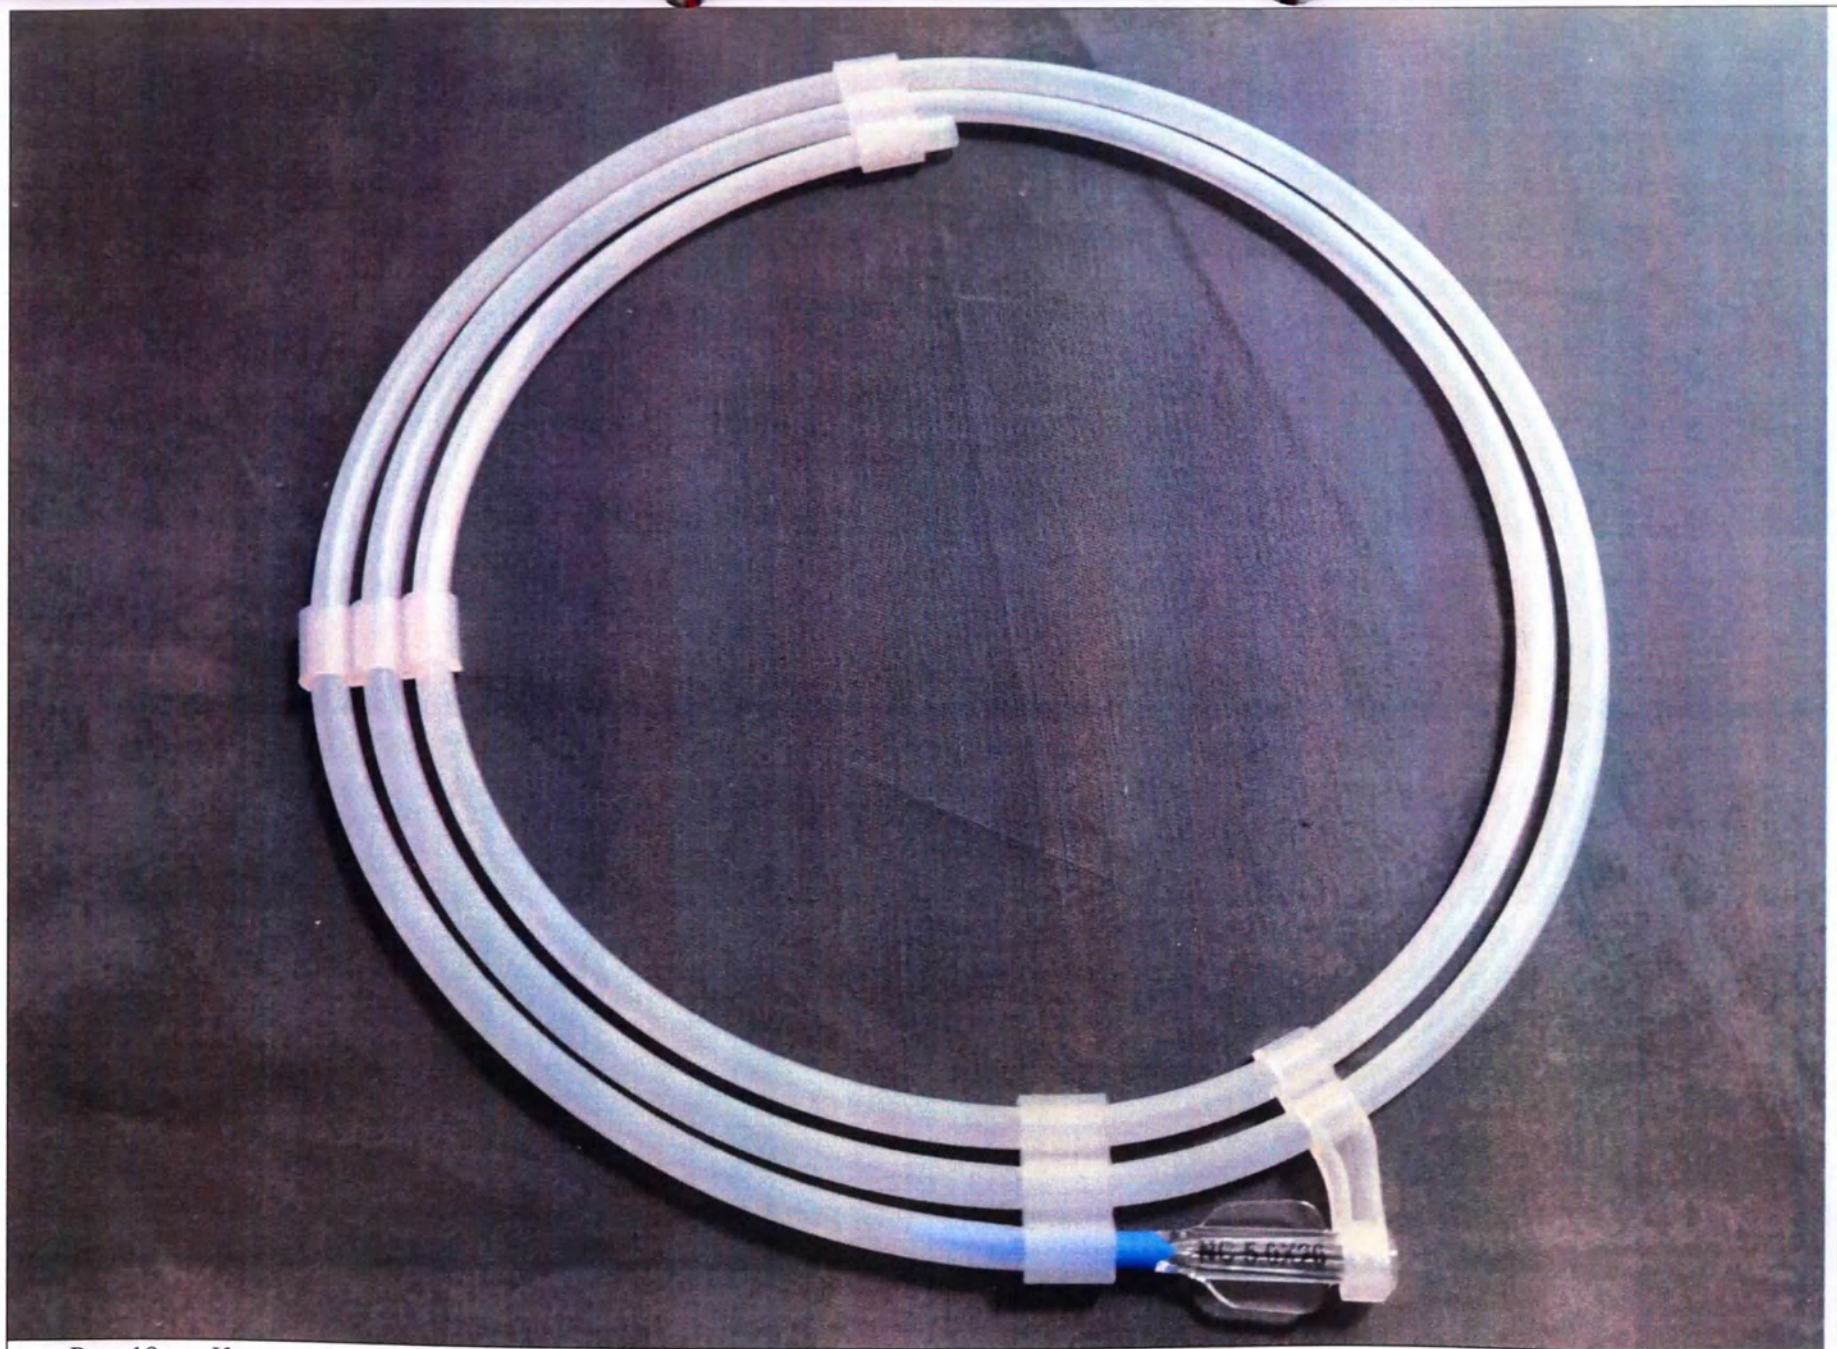


Рис. 19. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 20 мм

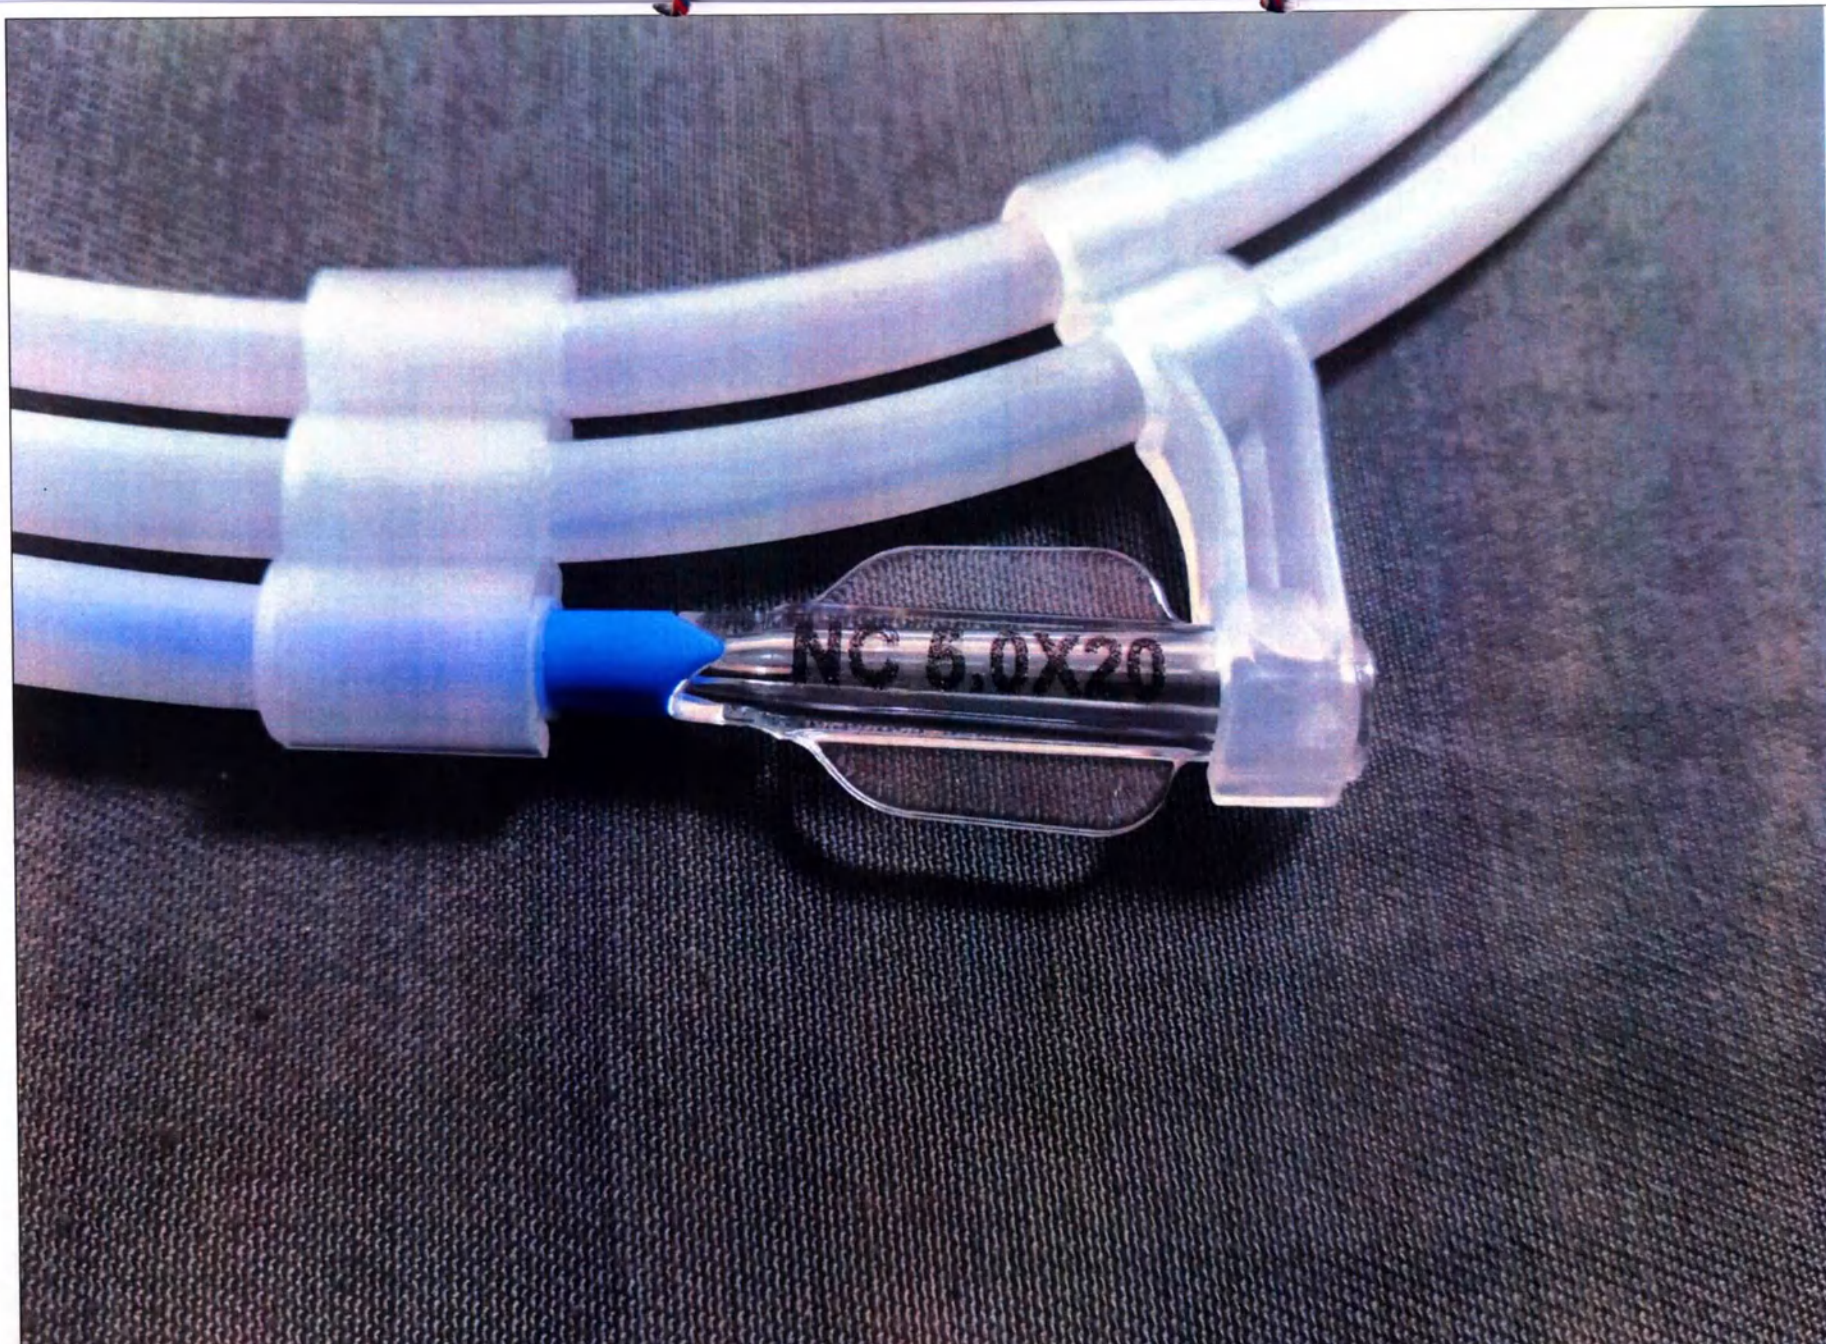


Рис. 20. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 20 мм

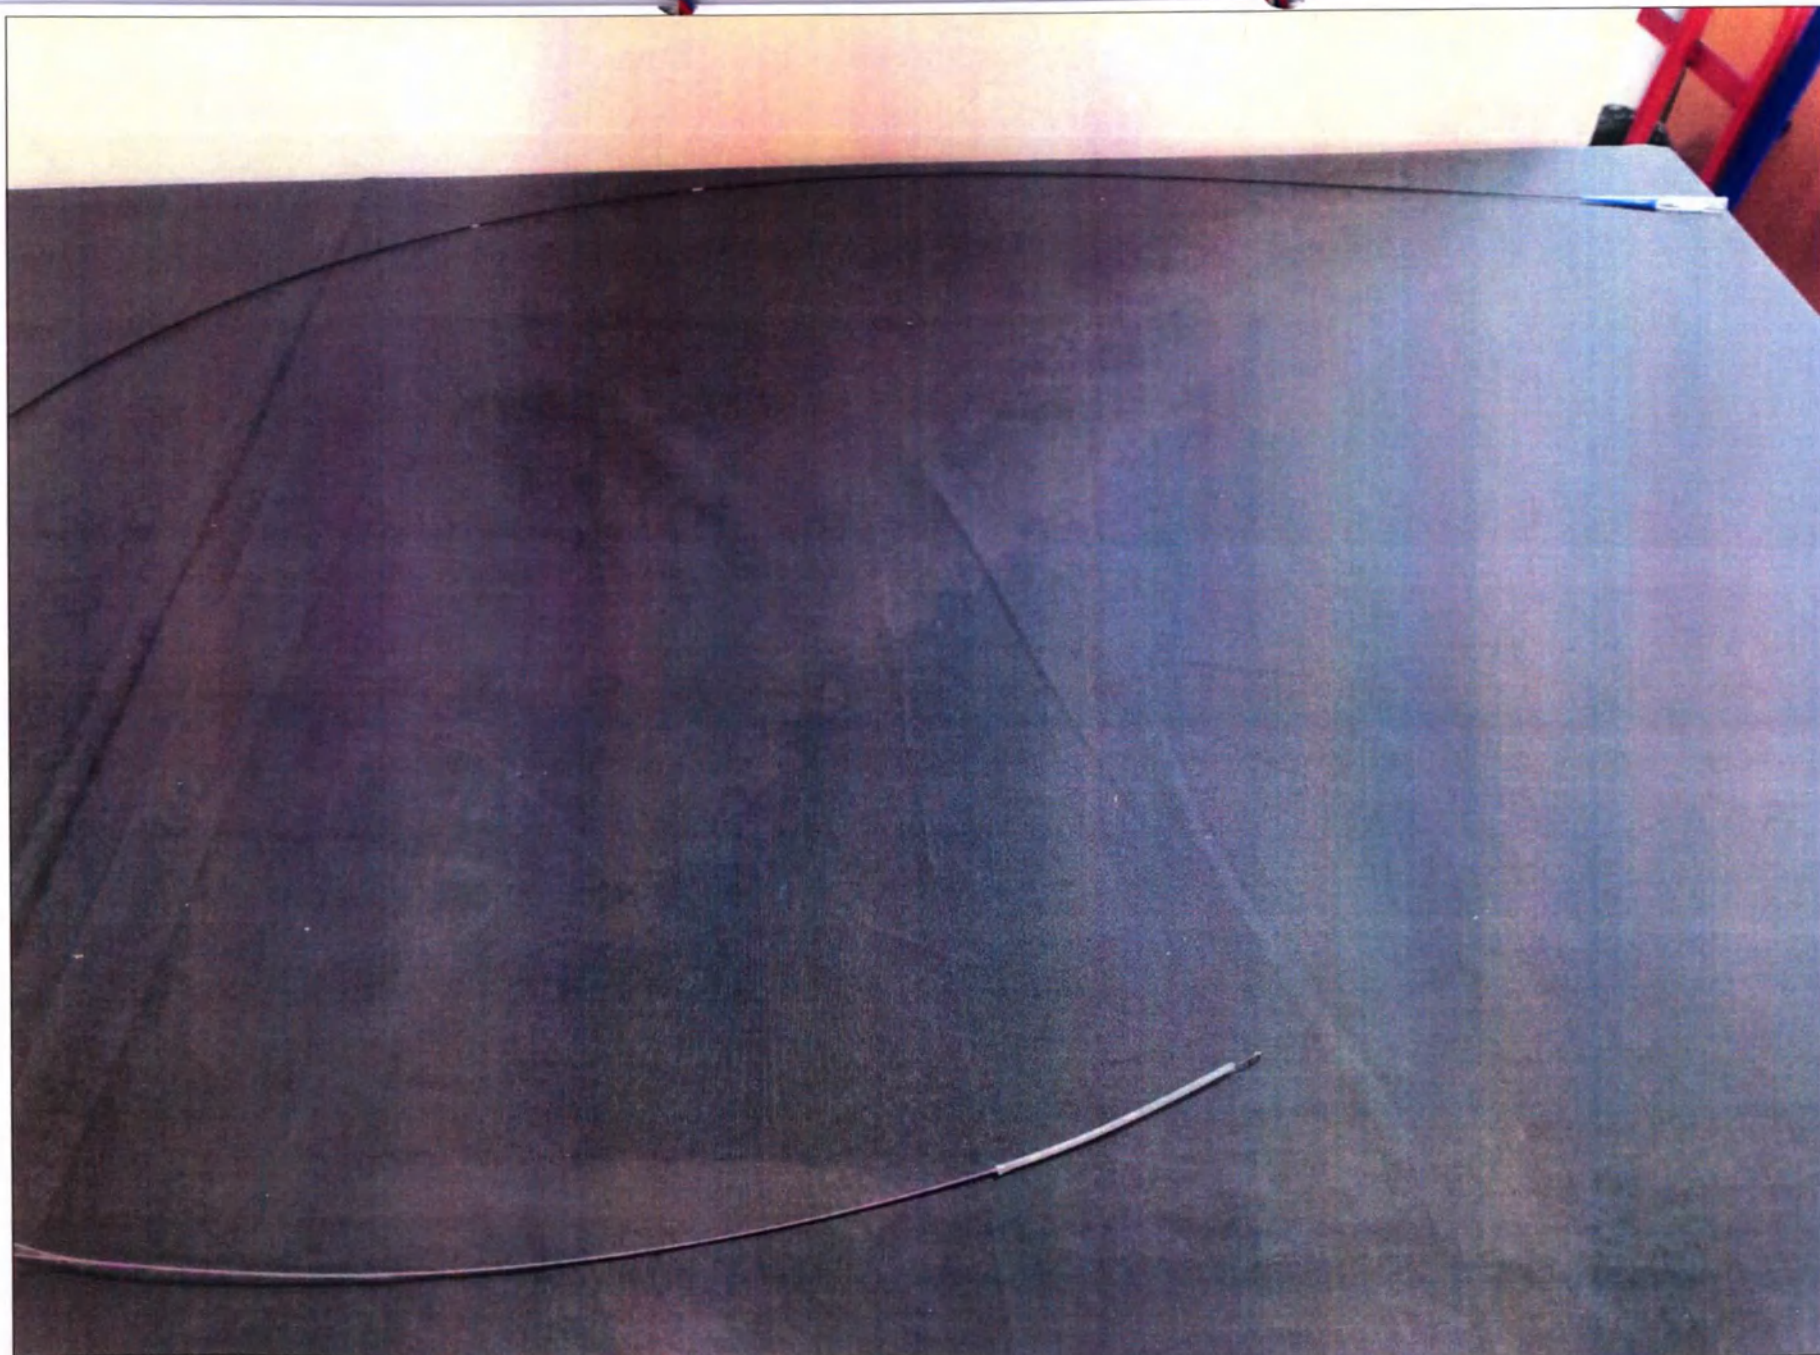


Рис. 21. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 20 мм

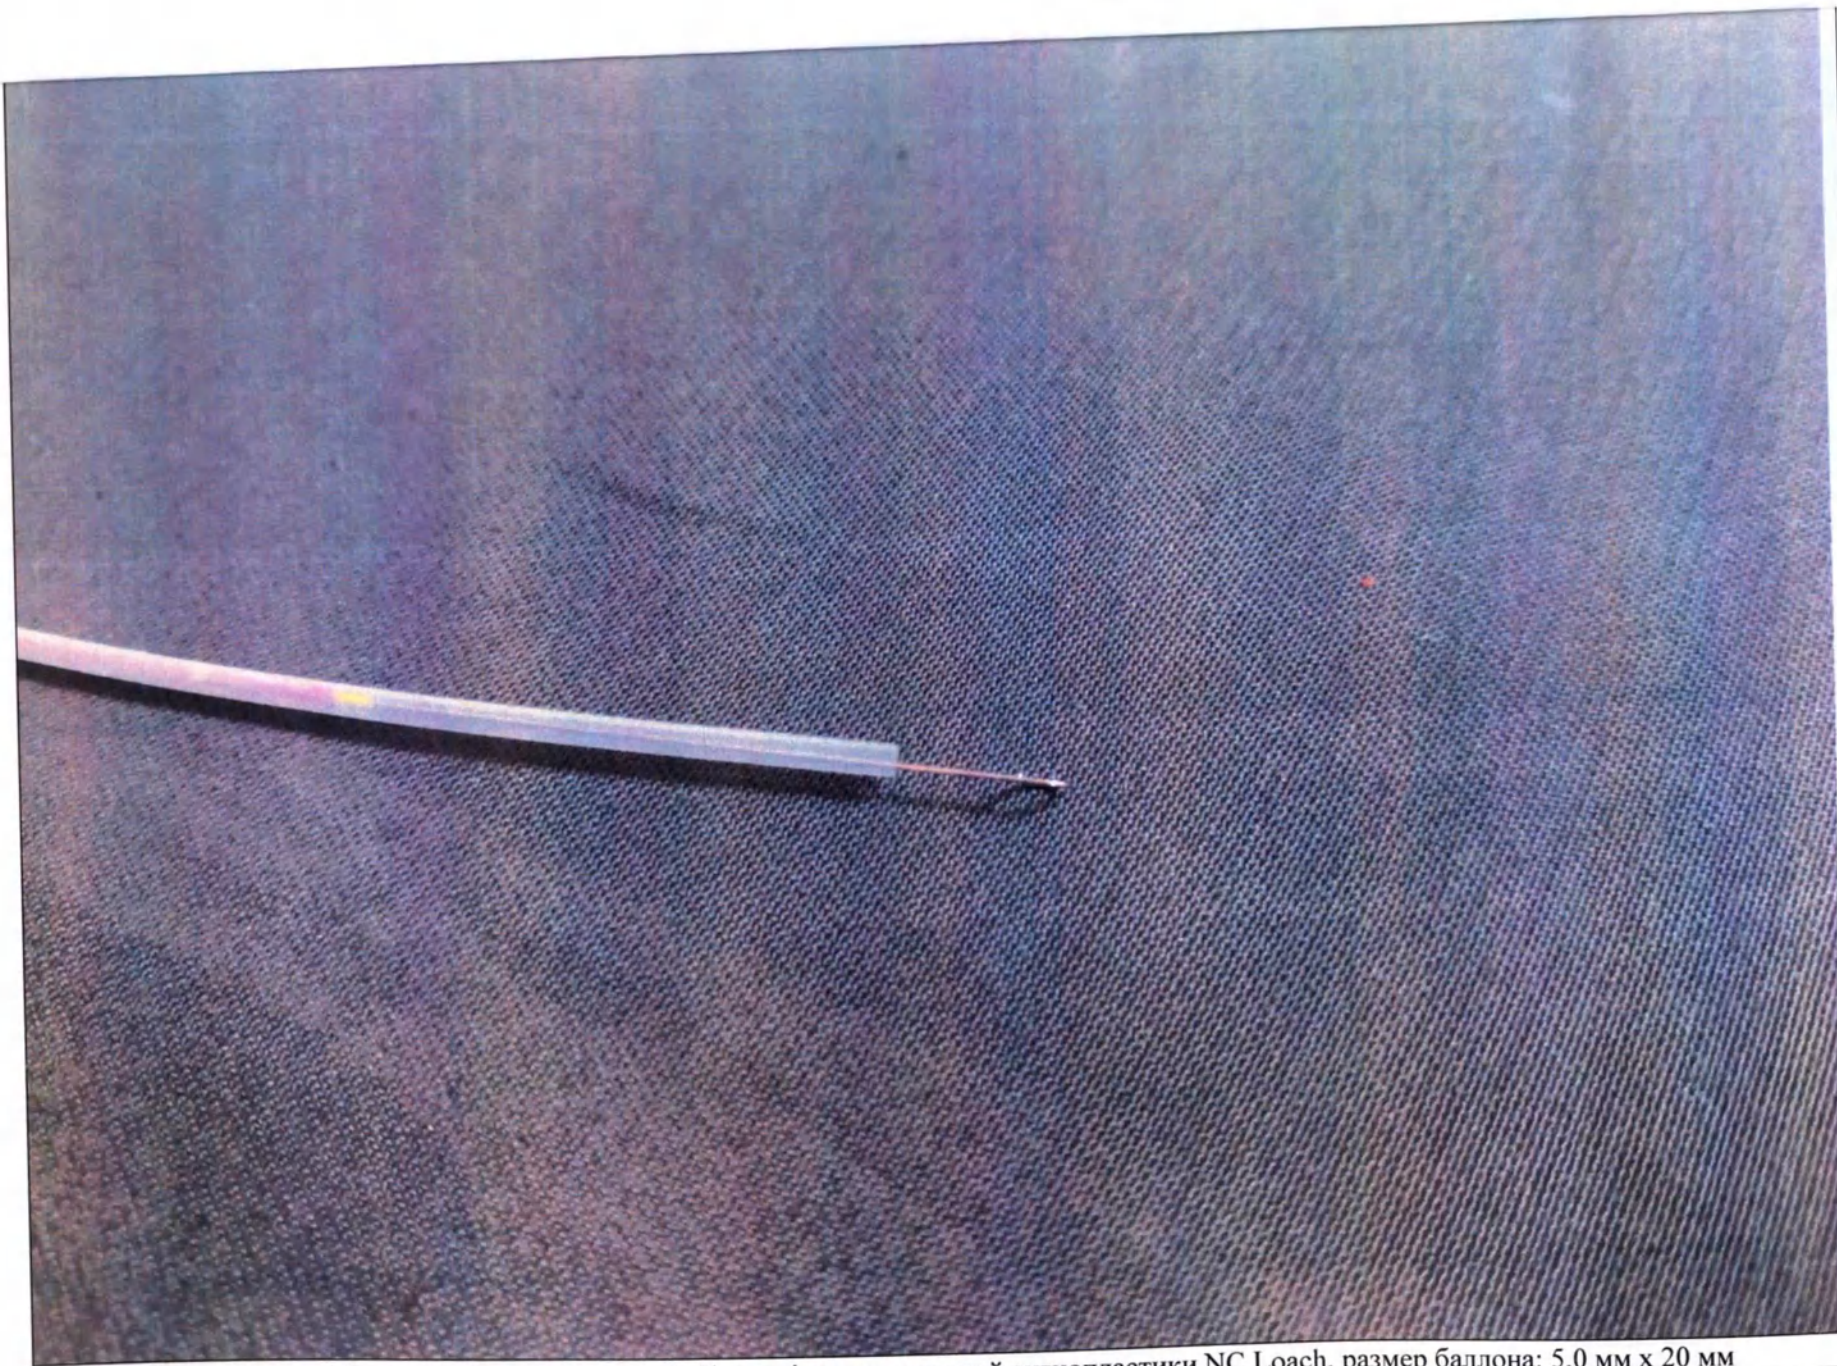


Рис. 22. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 20 мм

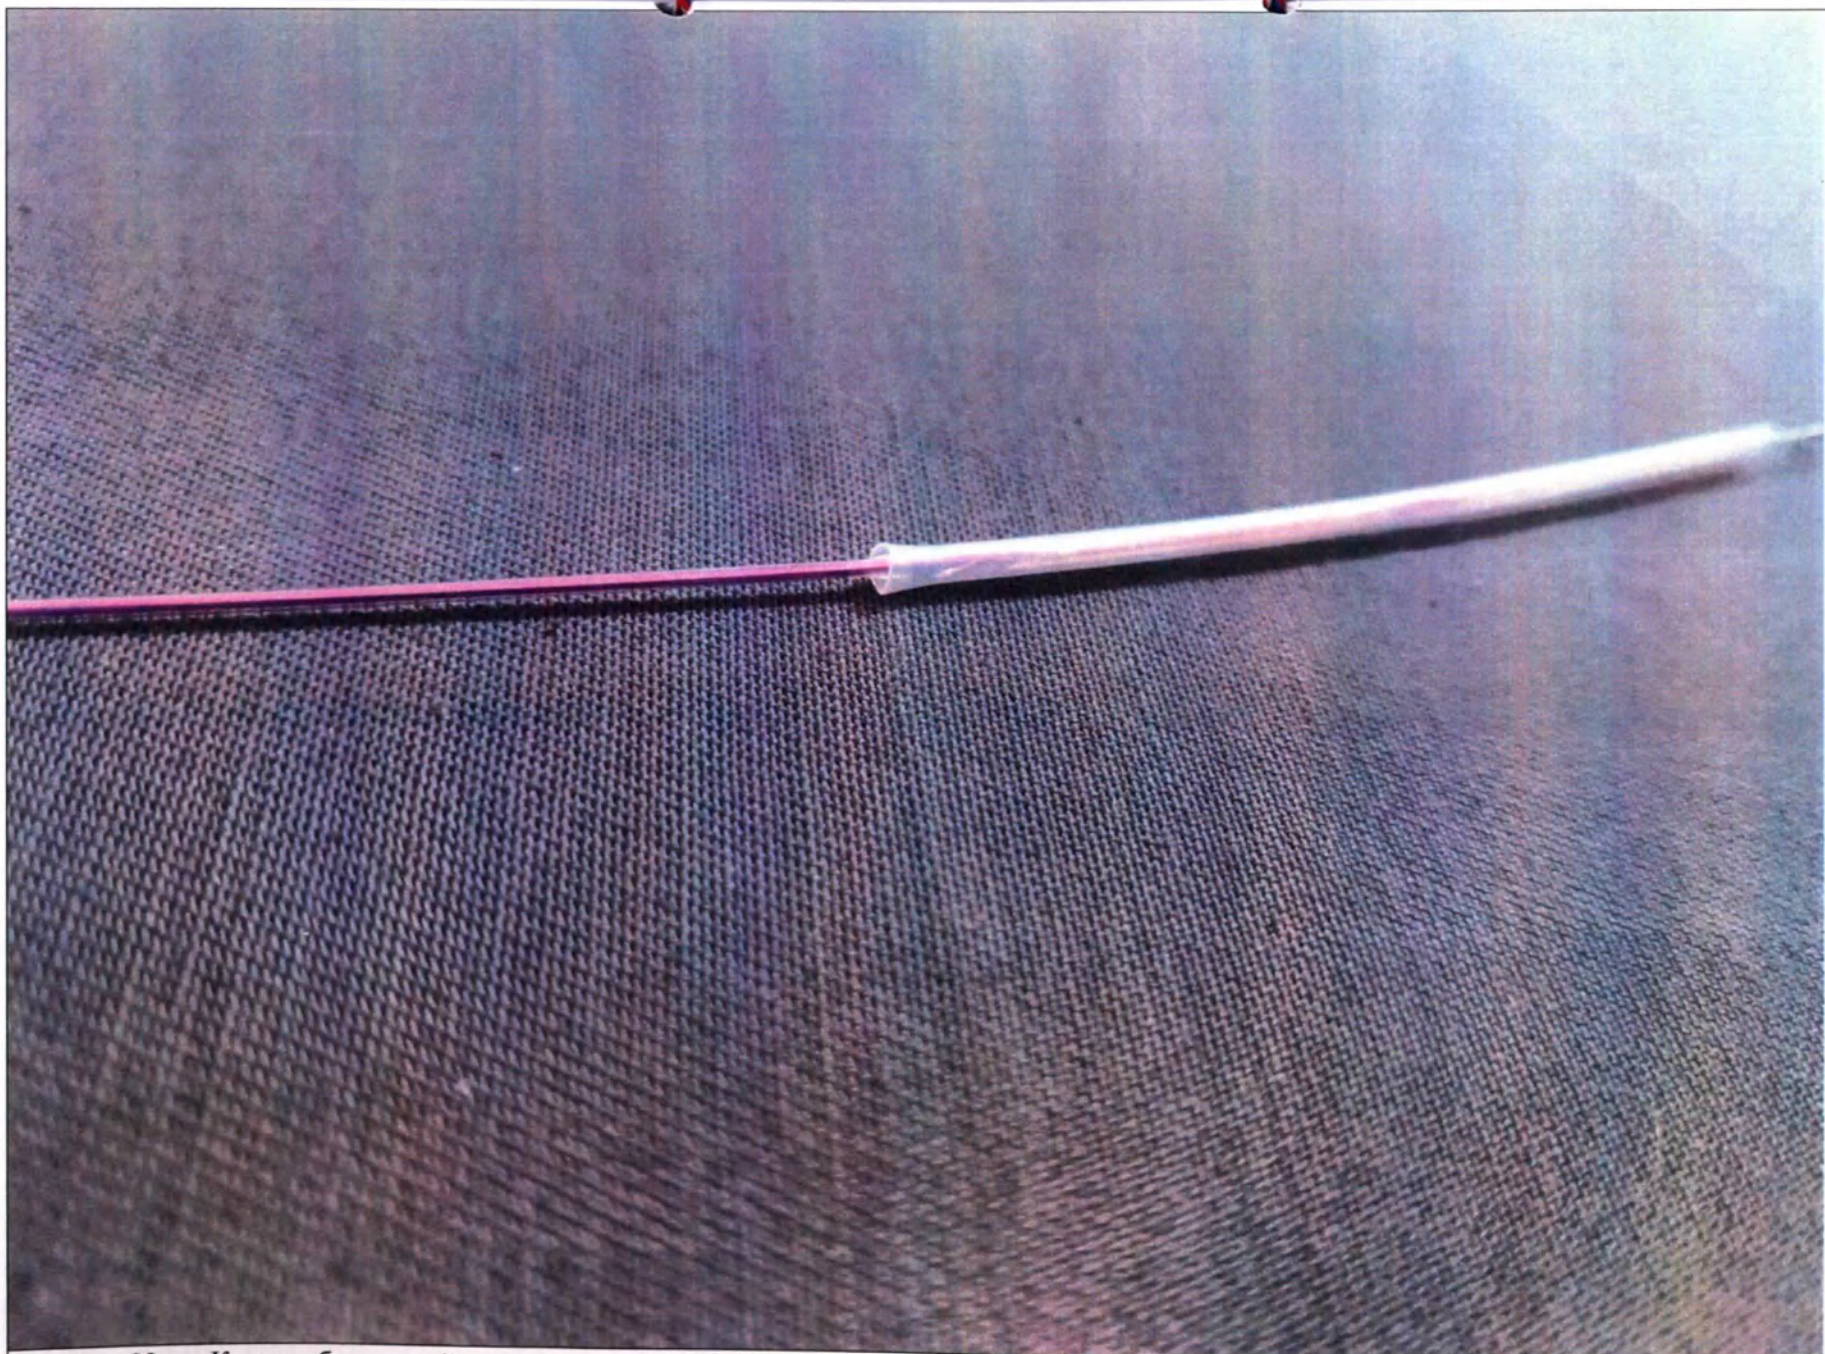


Рис. 23. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 20 мм



Shunmei
Medical technology creates future

RX 1.0x5
mm mm



PTCA
Shun Loach

Shunmei
Balloon Dilatation Catheter

RX Semi-Compliance


202311
202610
LOT 2311016L



Coronary Dilatation Catheter; Cathéter de dilatation coronaire; Coronaire-dilatatiekatheter; Katheter für die Koronardilatation; Koronardilatationskatheter; Catetere per dilatazione coronarica; Catéter de dilatación coronaria; Cateter de dilatação coronária; Κοιμήτης διαστολής στεφανιαίας αρτηρίας; Cewnik do poszerzania światła naczyń wieńcowych; Koronární dilatační katéter; 관상동맥확장 카테터; 冠状動脈擴張導管; 冠状動脈擴張導管

$\rho \geq 5Fr$
0.057" (1.42mm)

1.0mm

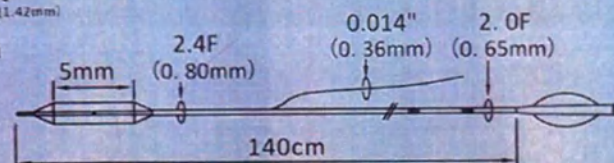

ϕ 1.0mm

5mm

642972

2311016L

202311

202610

Pressure		Balloon Diameter (mm)
ATM	KPa	
2	203	0.90
4	405	0.95
6 (NPI)	608	1.00
8	810	1.05
10	1013	1.10
12	1216	1.15
14	1418	1.20
16 (RBP)	1621	1.25
18	1823	1.30

Do not exceed the rated burst pressure (RBP).

Shunmei Medical Co., Ltd
Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China

Factory:
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China
File No.: SM-LB-PTCA(BDCI)-001
Version: A 5 Effective date: 2021.05.10

PTCA Balloon 1.0mmx5mm



642972

2311016L

PTCA Balloon 1.0mmx5mm



642972

2311016L

CE
2696

PTCA
Shun Loach

1.0x5
mm mm

RX Semi-Compliance




Рис. 25. Маркировка на транспортной упаковке

Shunmei® RX Semi-Compliance Balloon Dilatation Catheter

PTCA
Shun Loach

Coronary Dilatation Catheter; Cathéter de dilatation coronaria; Coronaire-dilatationskatheter; Katheter für die Koronar dilatation;
Koronardilatationskatheter; Catetere per dilatare coronarica; Cathéter de dilatación coronaria; Catetor de dilatação coronária;
Koronardilatationskatheter; Catetere per dilatare coronarica; Cathéter de dilatación coronaria; Catetor de dilatação coronária;
Koronardilatationskatheter; Catetere per dilatare coronarica; Cathéter de dilatación coronaria; Catetor de dilatação coronária;
冠狀動脈擴張導管; 冠狀動脈擴張導管; 冠狀動脈擴張導管; 冠狀動脈擴張導管

5Fr
1.4mm

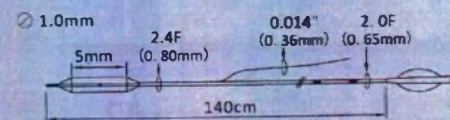

1.0mm	5mm
642972	2311016L
202311	202610

Pressure	ATM	MPa	Balloon Diameter (mm)
2	203	0.90	
4	405	0.95	
6	607	1.00	
8	810	1.05	
10	1013	1.10	
12	1216	1.15	
14	1418	1.20	
16	1621	1.25	
18	1823	1.30	

Shunmei Medical Co., Ltd.
Head Office: 1st Floor, No. 121 of Building B
No. 8 of 1st Floor, Building Industrial Zone,
Ganggang District, 518026 Shenzhen, Guangdong, China
Factory:
No. 1st road, 1st Industrial Zone, Pingtan Town,
Huizhou District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +86-20-23110161
Email: shunmei@shunmei.com
Website: shunmei.com
CE REP Lotus NL B.V.
Kortrijksesteenweg 18, 3410 Wilrijk, Belgium
The Hague, Netherlands
Tel: +31644188889
Email: peter@lotus.nl
Made in China
File No.: 24-14-ATPCA/043-001
www.shunmei.com

PTCA Balloon 1.0mmx5mm
642972 2311016L
PTCA Balloon 1.0mmx5mm
642972 2311016L

Do not exceed the rated burst pressure (RBP).

PTCA 1.0x5 mm mm RX Semi-Compliance


Shunmei® PTCA 1.0x5
Balloon Dilatation Catheter

Shunmei® RX Semi-Compliance PTCA Shun Loach
Medical technology creates future

Рис. 26. Пример вторичной упаковки

**NC
Loach**

5Fr
1.25" x 0.42mm



Pressure		Cathode Diameter (mm)
ATM	MPa	
5	0.68	1.94
8	0.90	1.96
10	1.013	1.98
12	1.21	2.00
14	1.418	2.02
16	1.621	2.04
18	1.823	2.06
20	2.026	2.08
22	2.229	2.10
24	2.431	2.12
26	2.634	2.14

Shunmei Medical Co., Ltd
Head Office: 2nd Floor and 3rd Floor of No. 16
 Road of 1st Street East, Xuefeng Industrial of Dong
 Long District, Shunde, 528311 Shunde, Guangdong, China
Factory:
 1st and 2nd Industrial Area, Pingtan Town,
 Hailing District, Hailing, Guangdong, China
 Tel: +86-757-358-5003
 Email: sales@shunmei.com
www.shunmei.com

CE **ISO 9001** **ISO 13485** **ISO 14001** **ISO 45001**
CE **ISO 9001** **ISO 13485** **ISO 14001** **ISO 45001**
 Tel: +86-757-358-5003
 Email: sales@shunmei.com
 made in China
 Tel: +86-757-358-5003
 Email: sales@shunmei.com
 Website: www.shunmei.com

CE **ISO 9001** **ISO 13485** **ISO 14001** **ISO 45001**
CE **ISO 9001** **ISO 13485** **ISO 14001** **ISO 45001**
 Tel: +86-757-358-5003
 Email: sales@shunmei.com
 made in China
 Tel: +86-757-358-5003
 Email: sales@shunmei.com
 Website: www.shunmei.com

NC Balloon 2.0mm*5mm

 17202010102511000
 17202010102511000

NC Balloon 2 0mmx6mm
[Barcode]
[Barcode]
[Barcode]

NC
Loach 2.0 x 6
mm mm

RX Non-Compliance

Shunmei NC 2.0x6
Ballpoint Pen Cartridge mm mm

Shunmei [®] **RX** *Non-Compliance*
Medical technology creates future

**NC
Loach**

Рис. 27. Пример вторичной упаковки

Shunmei and its subsidiaries.

SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD

Website: www.shunmed.com

SHUNMEI SP. Z O.O.

Website: www.shunmei.pl

SHUNMEI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED

Website: www.shunmei.in

**SHUNMEİ MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLAR
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Website: www.shunmei.com.tr

Рис. 28. Пример маркировки вторичной упаковки


Shunmei® RX Semi-Compliance

Balloon Dilatation Catheter

PTCA
Shun Loach

Coronary Dilatation Catheter; Cathéter de dilatation coronaire; Coronaire-dilatatiekatheter; Katheter für die Koronardilatation; Koronardilatationskatheter; Catetere per dilatazione coronarica; Catéter de dilatación coronaria; Cateter de dilatação coronária; Κοικτήρας διαστολής στεφανιαίου αγγείου; Cewnik do poszerzania światła naczyń wieńcowych; Koronární dilatální katétr; 관상동맥확장 카테터; 冠状動脈擴張導管; 冠状动脉扩张导管

ρ ≥ 5Fr
0.057" (1.42mm)

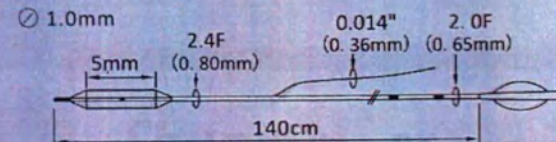

φ 1.0mm
5mm
642972
2311016L
202311
202610

Pressure		Balloon Diameter (mm)
ATM	KPa	
2	203	0.90
4	405	0.95
6 (NBP)	808	1.00
8	810	1.05
10	1013	1.10
12	1216	1.15
14	1418	1.20
16 (RBP)	1621	1.25
18	1823	1.30


Do not exceed the rated burst pressure (RBP).

PTCA Shun Loach 1.0x5 mm mm RX Semi-Compliance

Shunmei Medical Co., Ltd
Head Office: 3rd Floor and 4th of building B,
No. 8 of 1st Jirong Road, Baolong Industrial Zone,
Longjiang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory:
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +86-0752-3306349
Email: hns@shunmei.com
Web: www.shunmei.com
CE REP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2555AA,
The Hague, Netherlands
Tel: +31644164999
Email: peter@lotusnl.com
made in China
File No.: SM-LB-PTCA(RDC) 001
version: A.5 Effective date: 2021.05.10

PTCA Balloon 1.0mmx5mm
642972 2311016L

PTCA Balloon 1.0mmx5mm
642972 2311016L



Shunmei® PTCA 1.0x5 mm mm
Balloon Dilatation Catheter



2311016L
202311
202610

Shunmei® RX Semi-Compliance PTCA Shun Loach
Medical technology creates future

Рис. 29. Пример маркировки вторичной упаковки

Shunmei[®]
Medical technology creates future

RX 1.0x5
mm mm



PTCA
Shun Loach

Shunmei[®]
Balloon Dilatation Catheter

RX Semi-Compliance


202311
202610
LOT 2311016L



Coronary Dilatation Catheter; Cathéter de dilatation coronaire; Coronaire-dilatatiekatheter; Katheter für die Koronardilatation; Koronardilatationskatheter; Catetere per dilatazione coronarica; Catéter de dilatación coronaria; Cateter de dilatação coronária; Κοβητήρας διαστολής στεφανιαίας αρτηρίας; Cewnik do poszerzania światła naczyń wieńcowych; Koronární dilatační katétr; 관상동맥확장 카테터; 冠状動脈擴張導管; 冠状动脉扩张导管

$\rho \geq 5Fr$
0.057" (1.42mm)

1.0mm

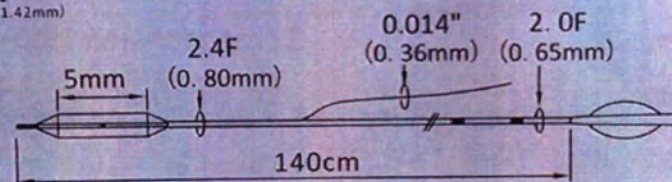

BALLOON ϕ 1.0mm
BALLOON 5mm
REF 642972
LOT 2311016L
202311
202610

Pressure		Balloon Diameter (mm)
ATM	KPa	
2	203	0.90
4	405	0.95
6 (NPI)	608	1.00
8	810	1.05
10	1013	1.10
12	1216	1.15
14	1418	1.20
16 (RBP)	1621	1.25
18	1823	1.30

Do not exceed the rated burst pressure (RBP).


Shunmei Medical Co., Ltd
Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No. 8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory:
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com
EC REP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China
File No.: 5M-LB-PTCA(BDC)-001
Version: A-5 Effective date: 2021.05.10

CE
2696

PTCA Balloon 1.0mmx5mm



PTCA Balloon 1.0mmx5mm



PTCA
Shun Loach 1.0x5
mm mm RX Semi-Compliance

Рис. 31. Пример маркировки первичной упаковки

Shunmei Medical Co., Ltd
Организация/Organization

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong
Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District,
518116 Shenzhen, Guangdong, China
Адрес/Address

General Manager
Должность/Occupation

Tu Zhenjin
Фамилия, Имя/ Surname, Name

27.05.2024
Дата ДД.ММ.ГГГГ/Date DD.MM.YYYY



Инструкция по применению на медицинское изделие:
«Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики в
вариантах исполнения»

Instruction for use
«Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty in variations»

2024

Рис. 32. Инструкция по применению

Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики в вариантах исполнения

РУ и дата Регистрационного удостоверения:

Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: XXX мм х XXX мм – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Эффективная длина: 140 см

Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», Китайская Народная Республика)

Юридический адрес производителя:

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China

Место производства медицинского изделия:

Shunmei Medical Co., Ltd

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Серия (LOT): см. на упаковке

Номер по каталогу (REF): см. на упаковке

Использовать до (M): см. на упаковке

Способ применения: См. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов: см. в инструкции по применению.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЦИСЗ», 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232;

Электронный адрес: office@hscmail.pro

Телефон: +7 (495) 798-01-60

Сделано в Китае

Рис. 33. Пример макета маркировки для РФ

Всего прошито, пронумеровано

(35) листов

Генеральный директор

ООО «ЦИСЗ»

Ширшов К.Г.

