




Фотографические изображения медицинского изделия

Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S10, Voluson S10 Expert с принадлежностями

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента Регистрации
и Сертификации, Россия и СНГ
ООО "ДжиИ Хэлскеа"

 А.П. Харитоновна

«28» декабря 2023 г.




Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской Voluson S10




Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской Voluson S10 Expert



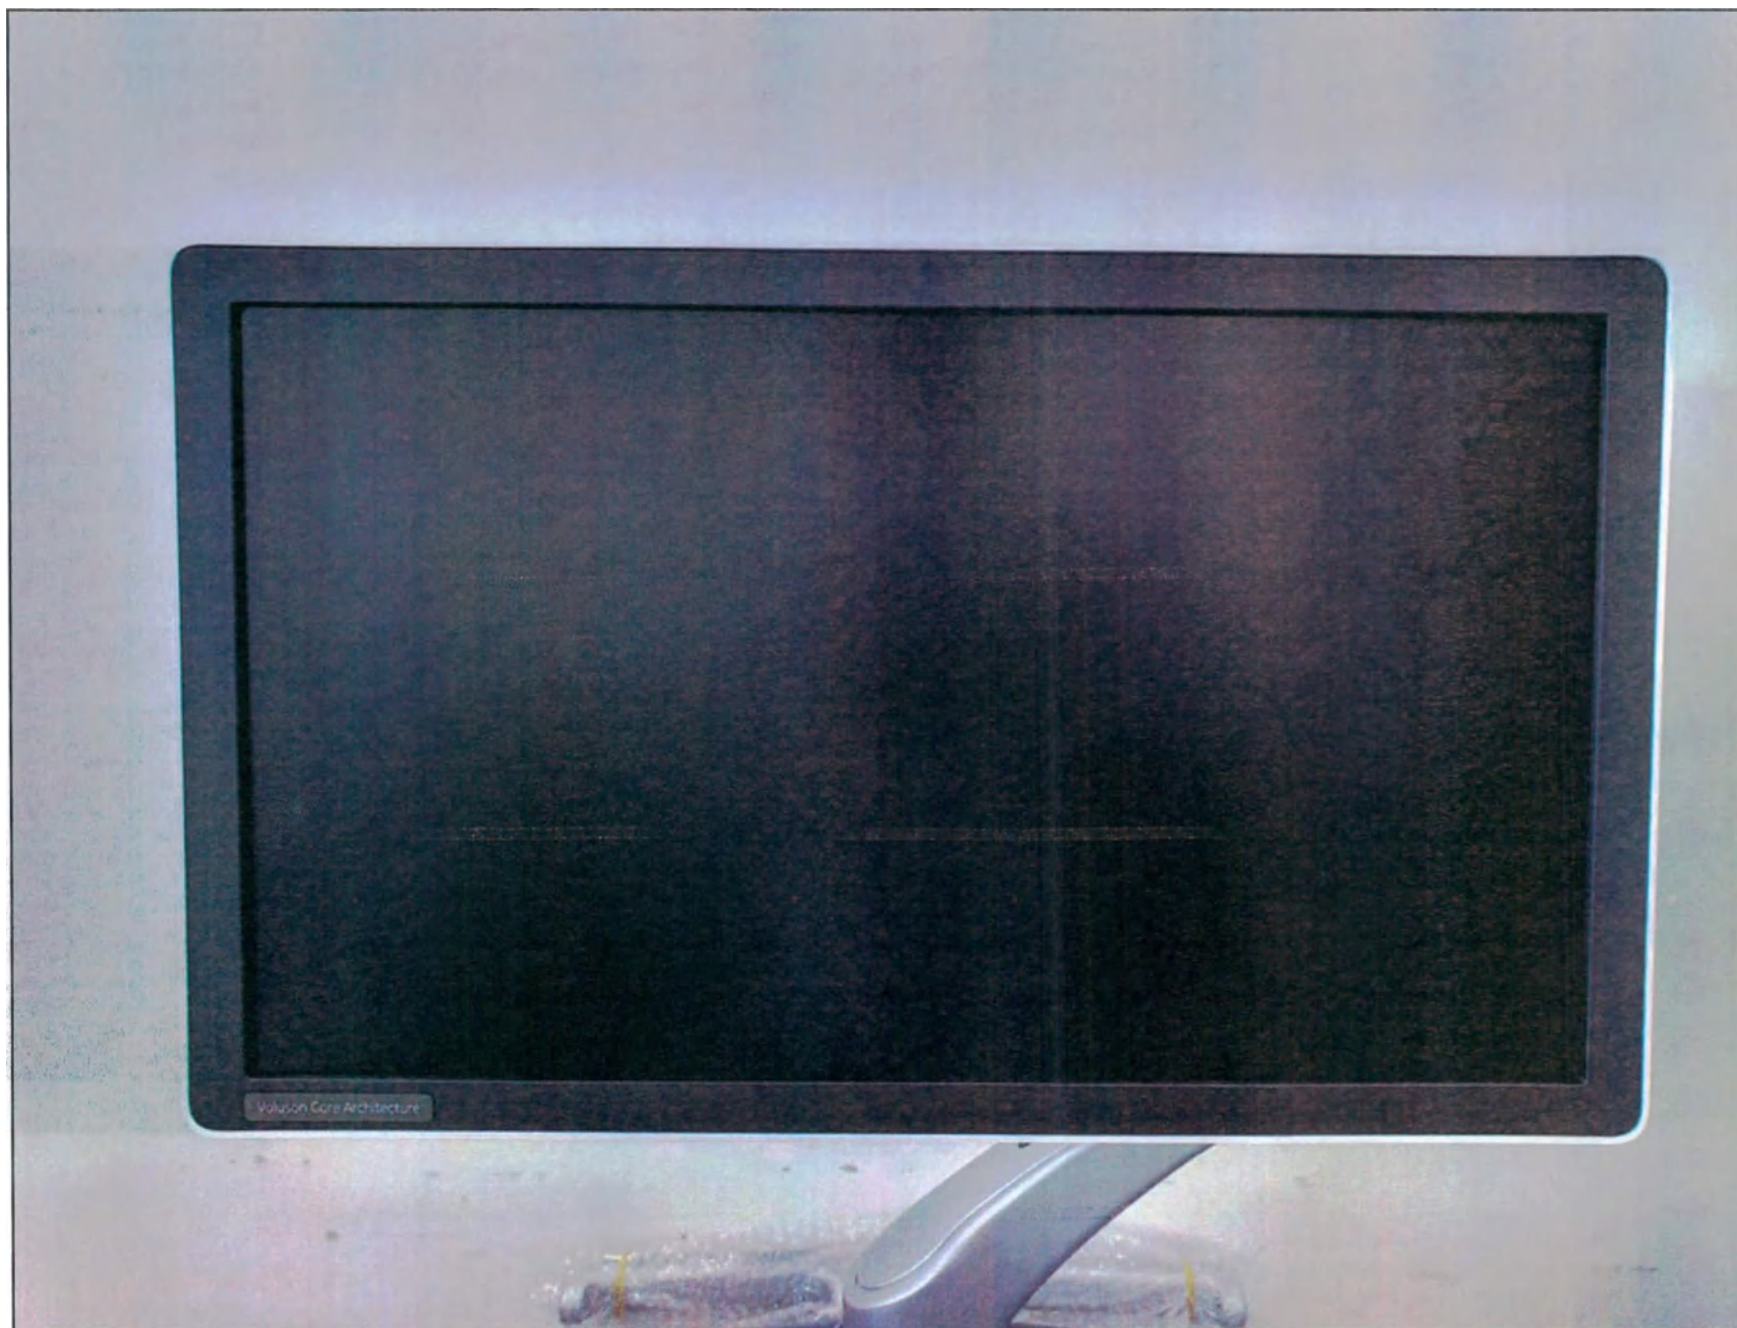

Монитор специальный медицинский

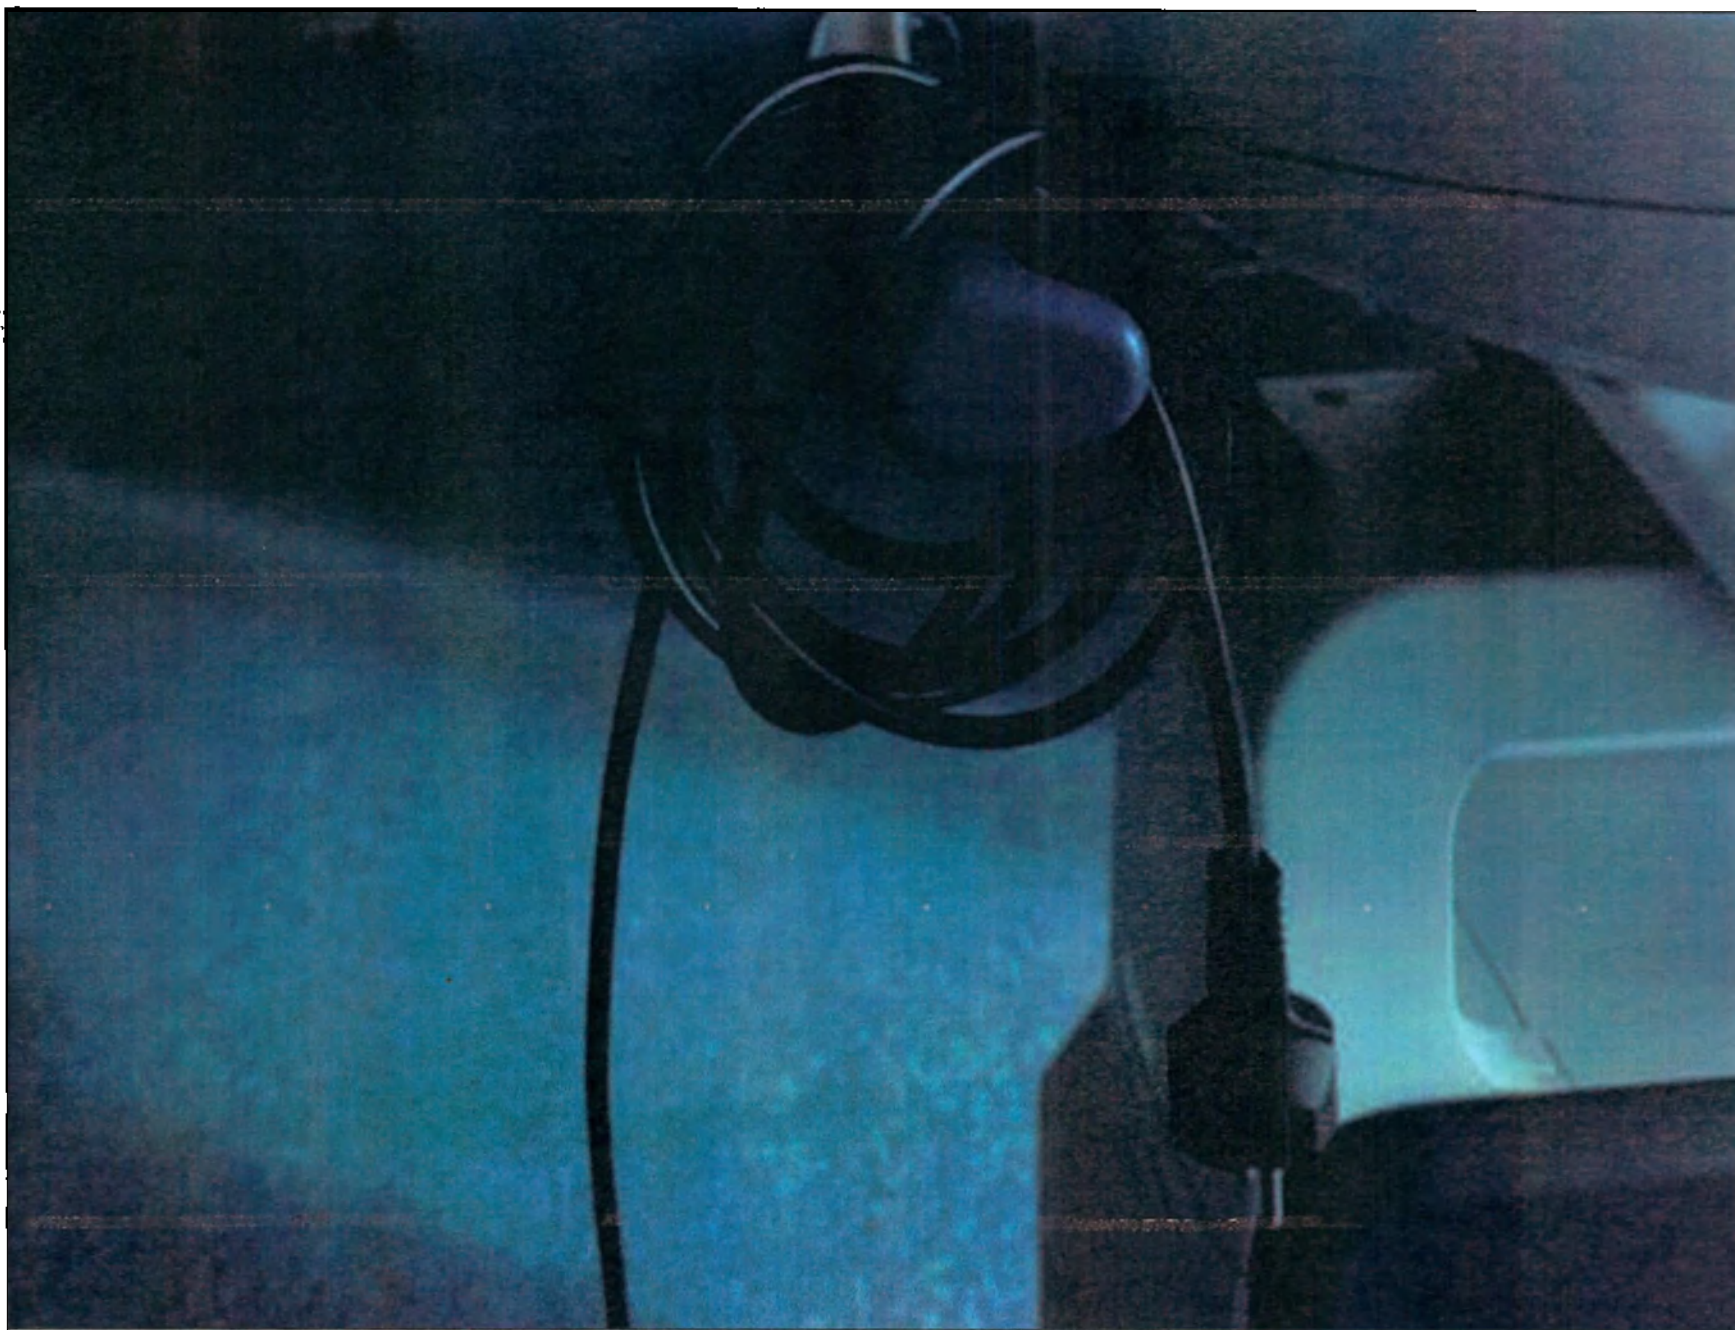

Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской

Voluson™ S10

Voluson™ S10 Expert

Voluson™ S8t

Основное руководство пользователя

На русском языке (Russian)



CE 0459




Редакция 6


Номер по каталогу 5773160-145

SPC330

© General Electric, 2018–2021

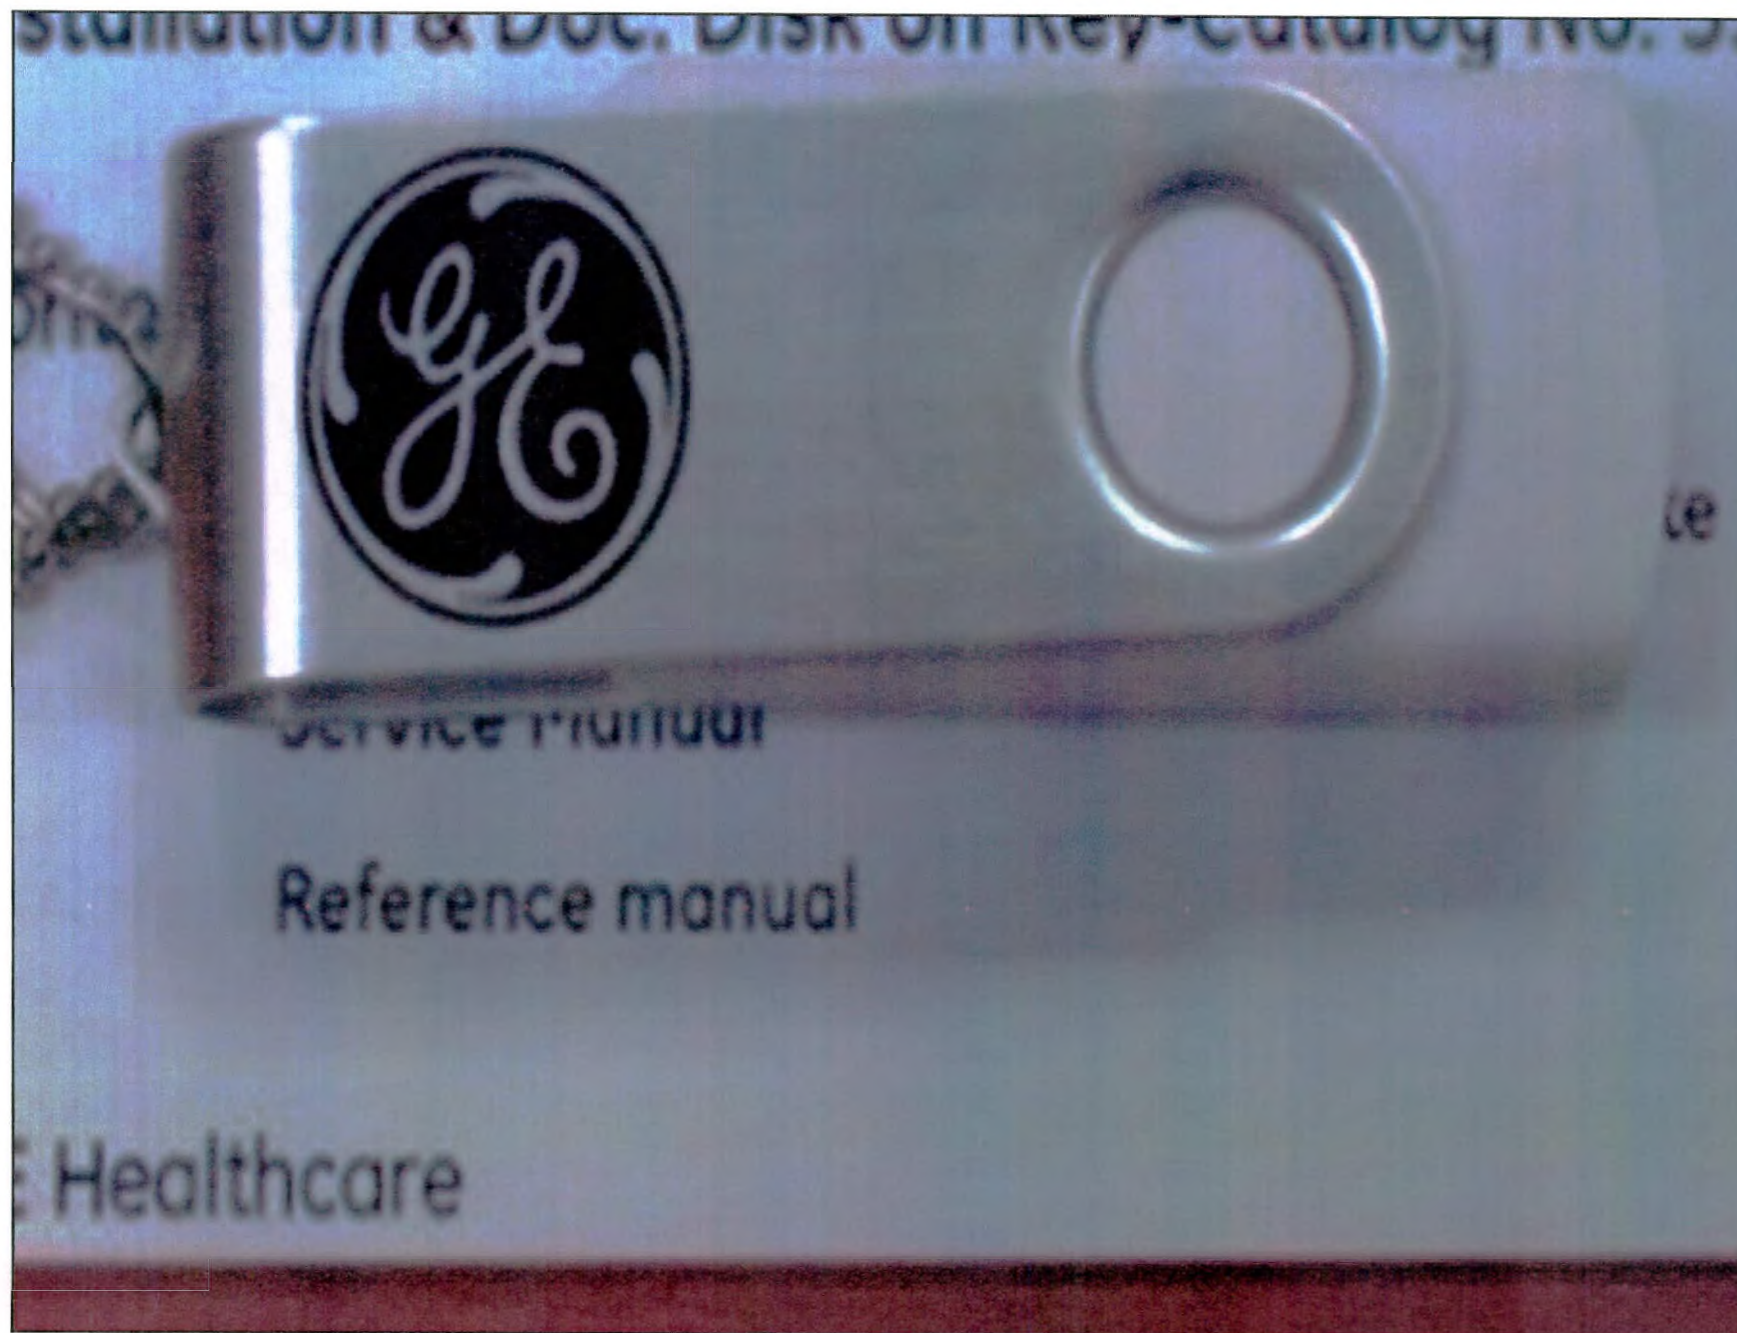

Электронная документация на CD/DVD/USB eDoc

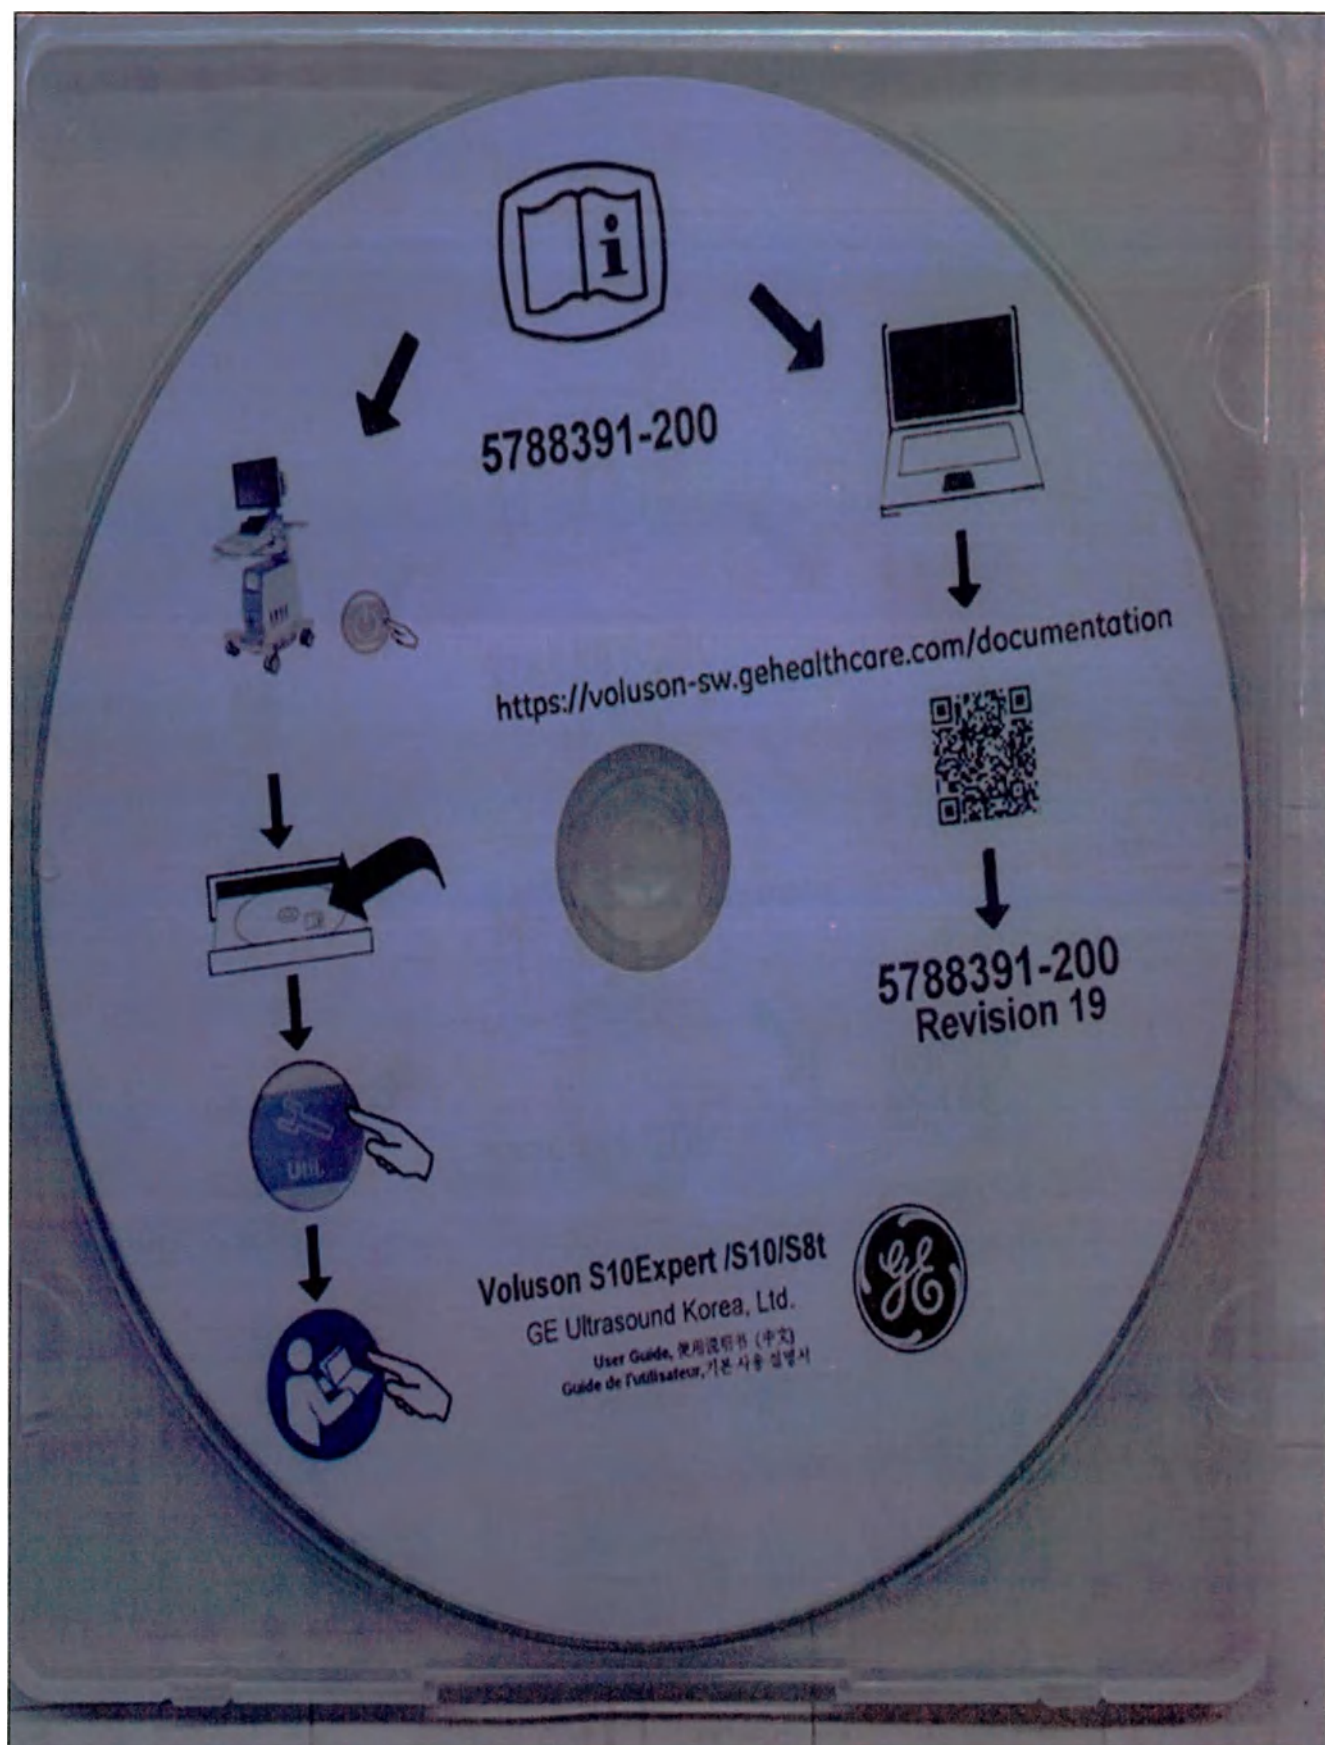

Voluson™ S10
Voluson™ S10 Expert
Voluson™ S8t
Basic User Manual
English (English)




Revision 6


Part number 5773180-100

SPC330

© 2018-21 by General Electric

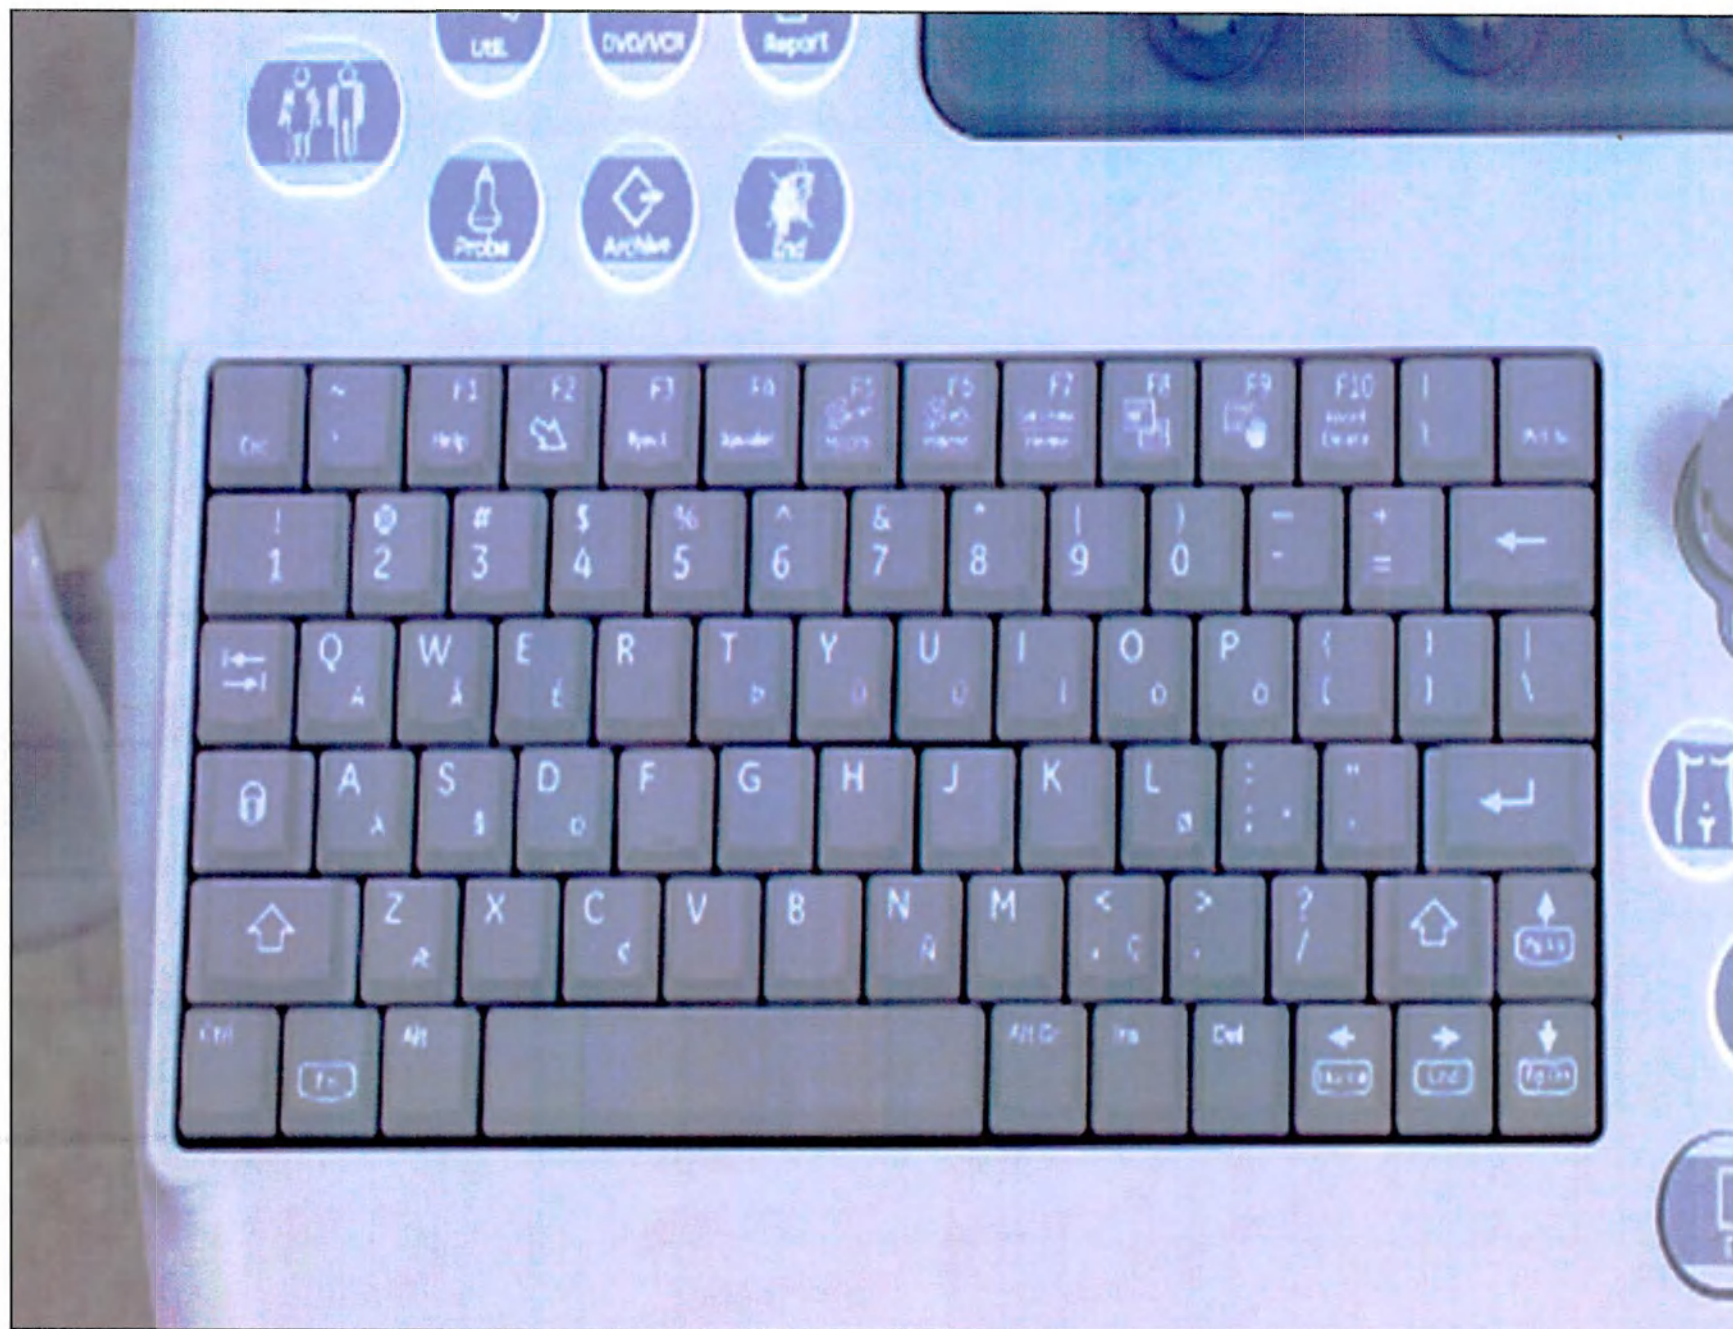

Накладки на клавиатуру русифицированные

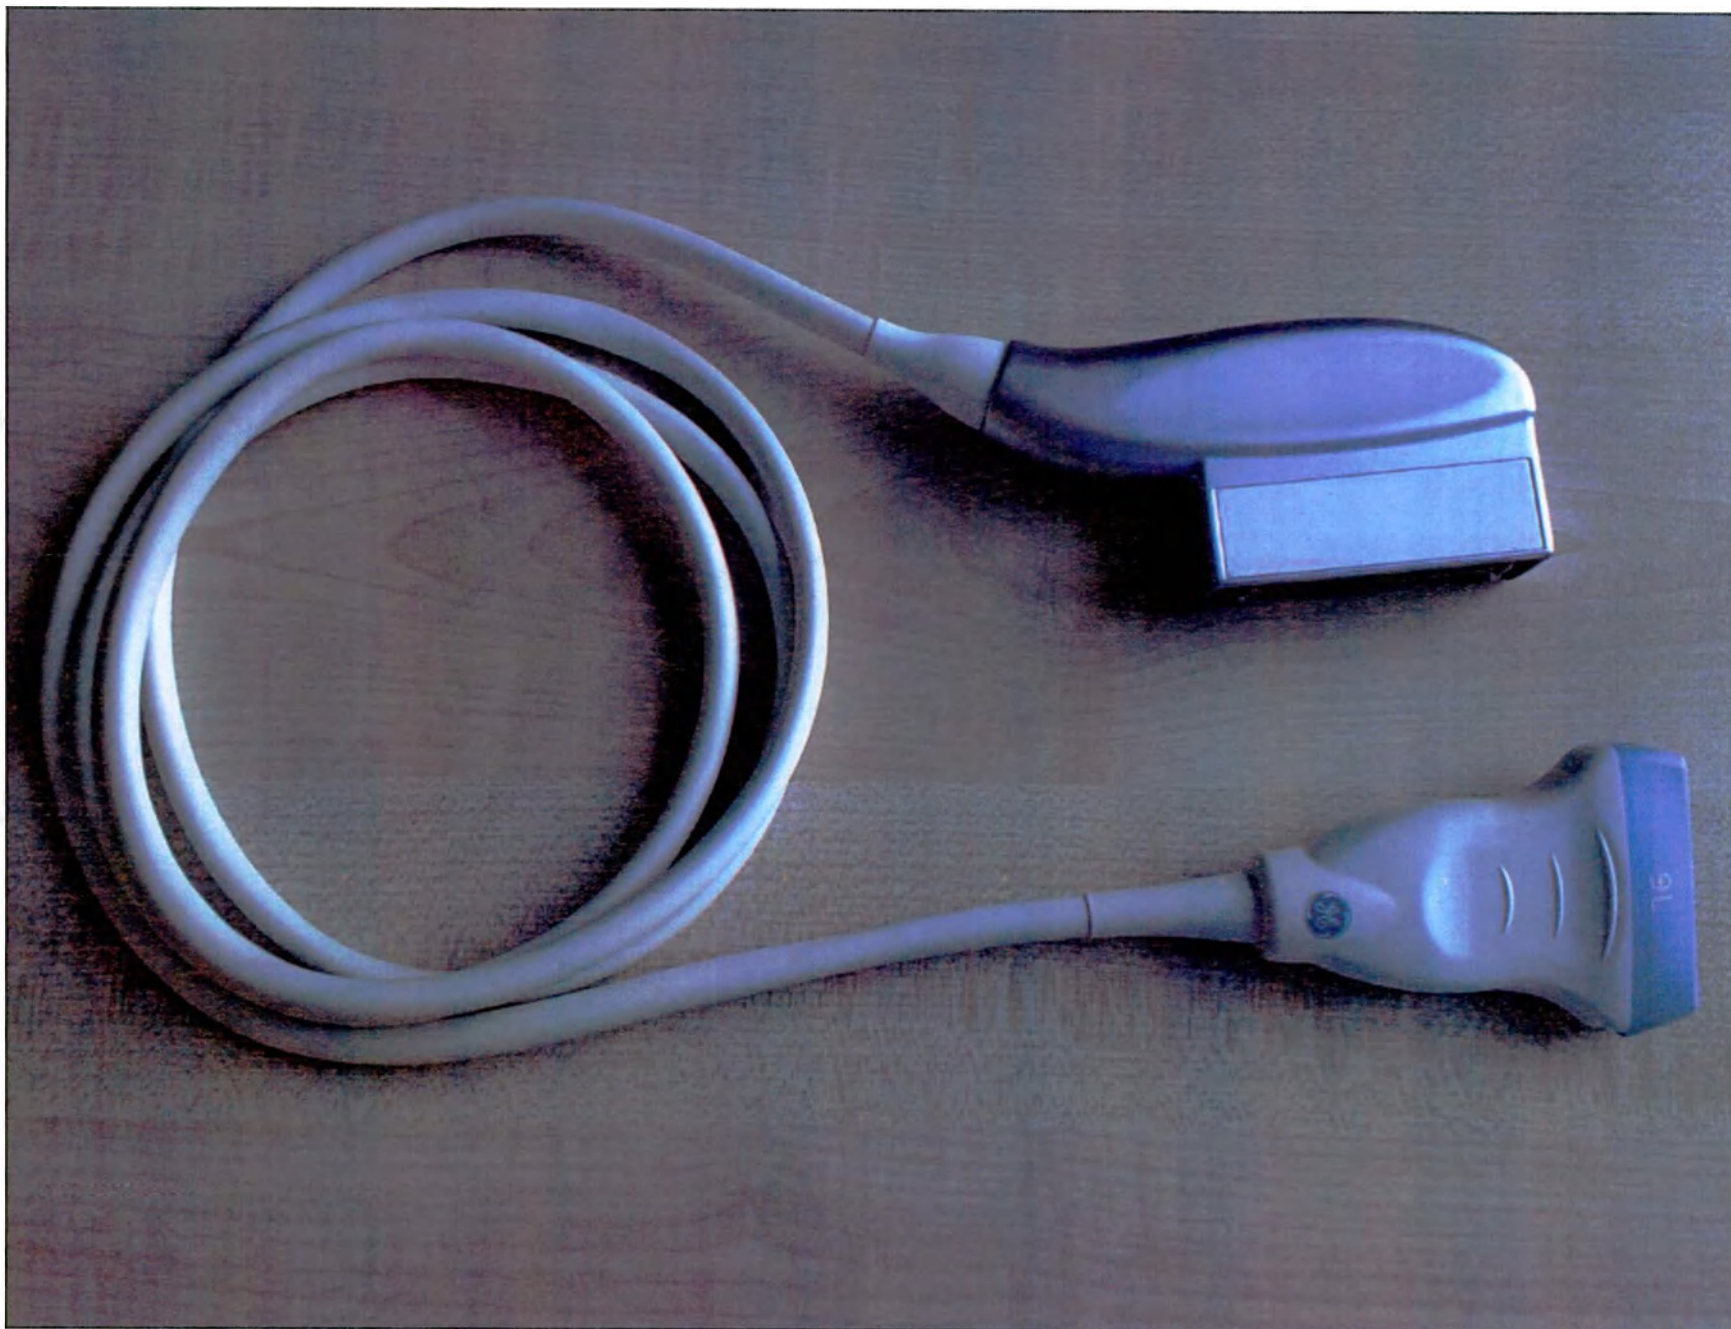

Датчик линейный 9L-RS




Датчик линейный 12L-RS




Биопсийные насадки для датчиков линейных 9L-RS




Биопсийные насадки для датчиков линейных 12L-RS

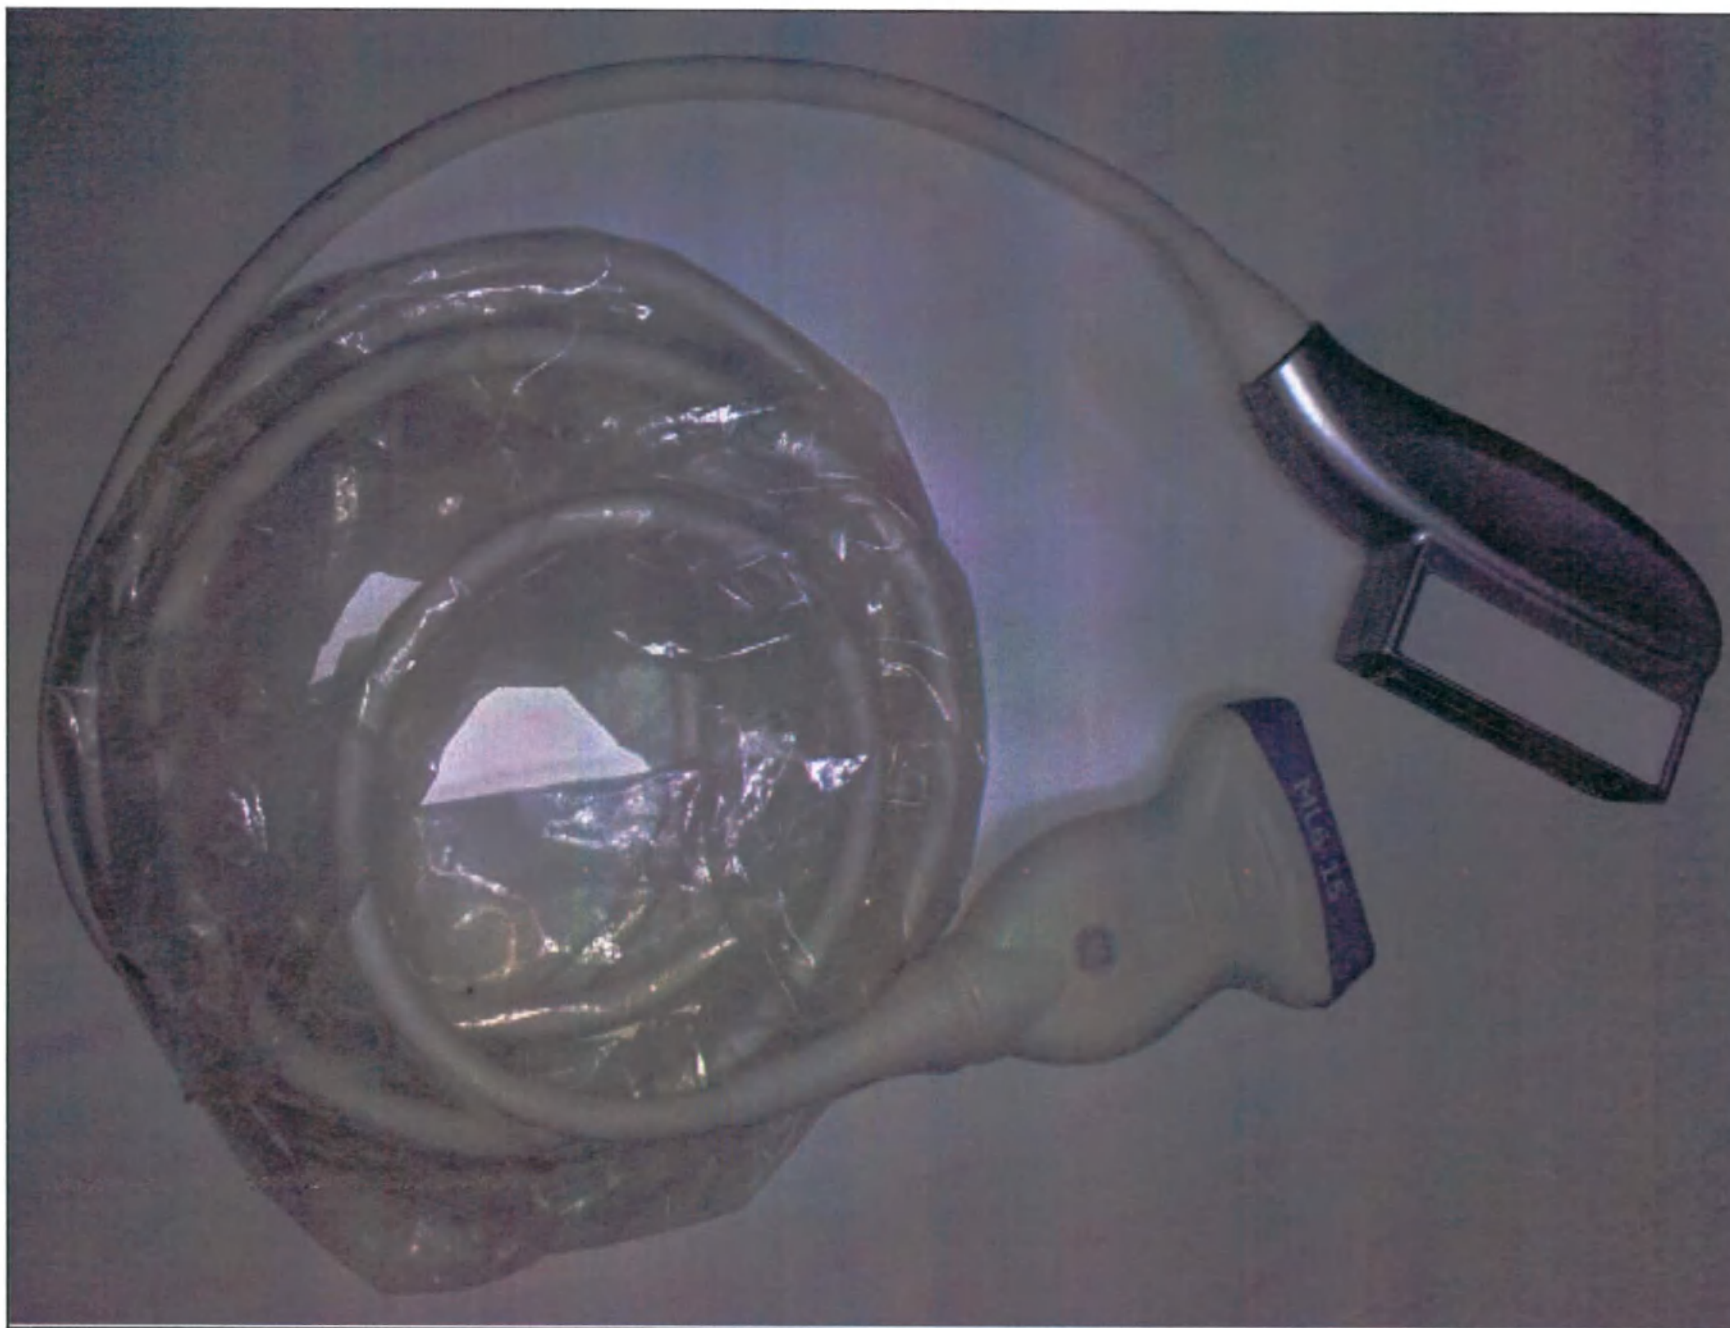


Датчик матричный линейный ML6-15-RS

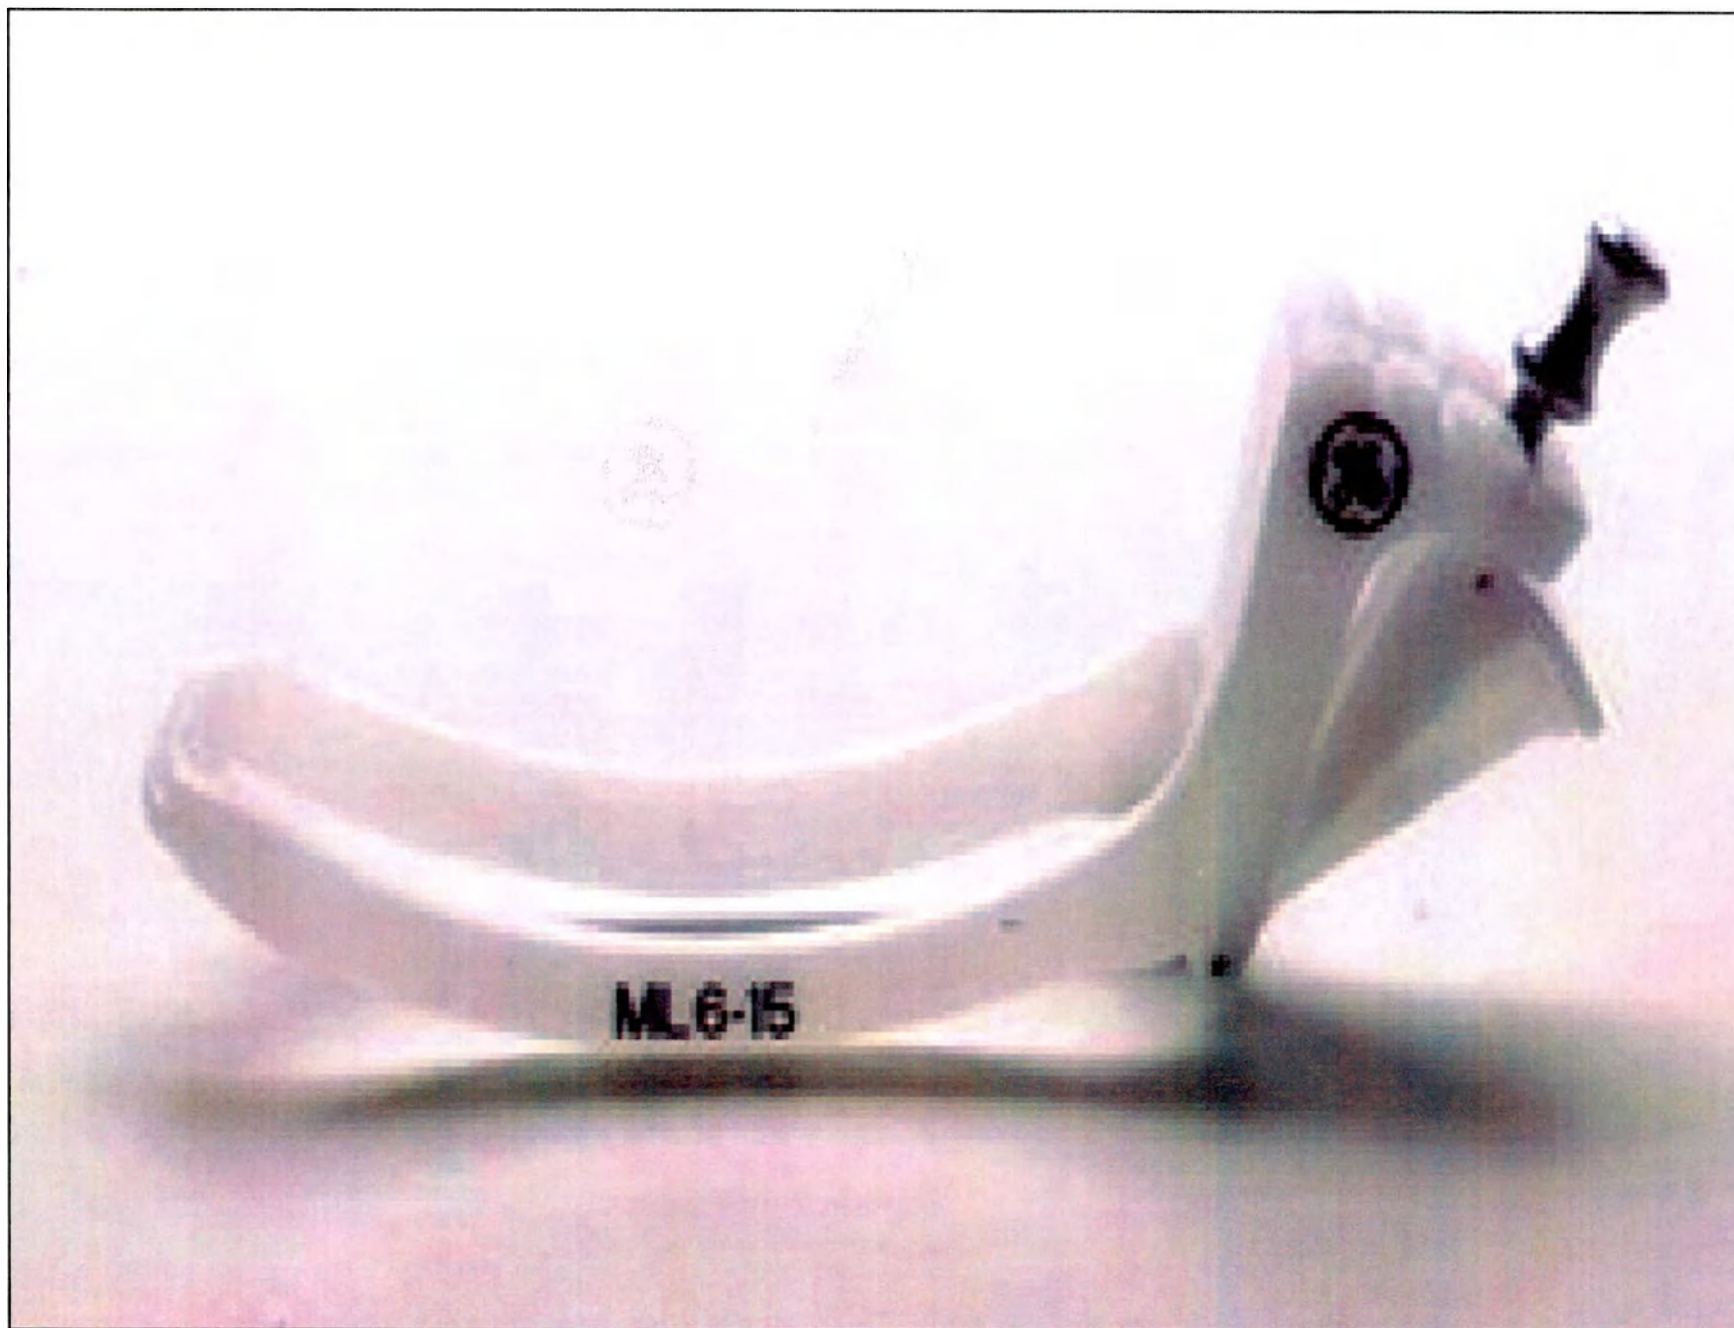

Биопсийные насадки для матричного линейного датчика ML6-15-RS

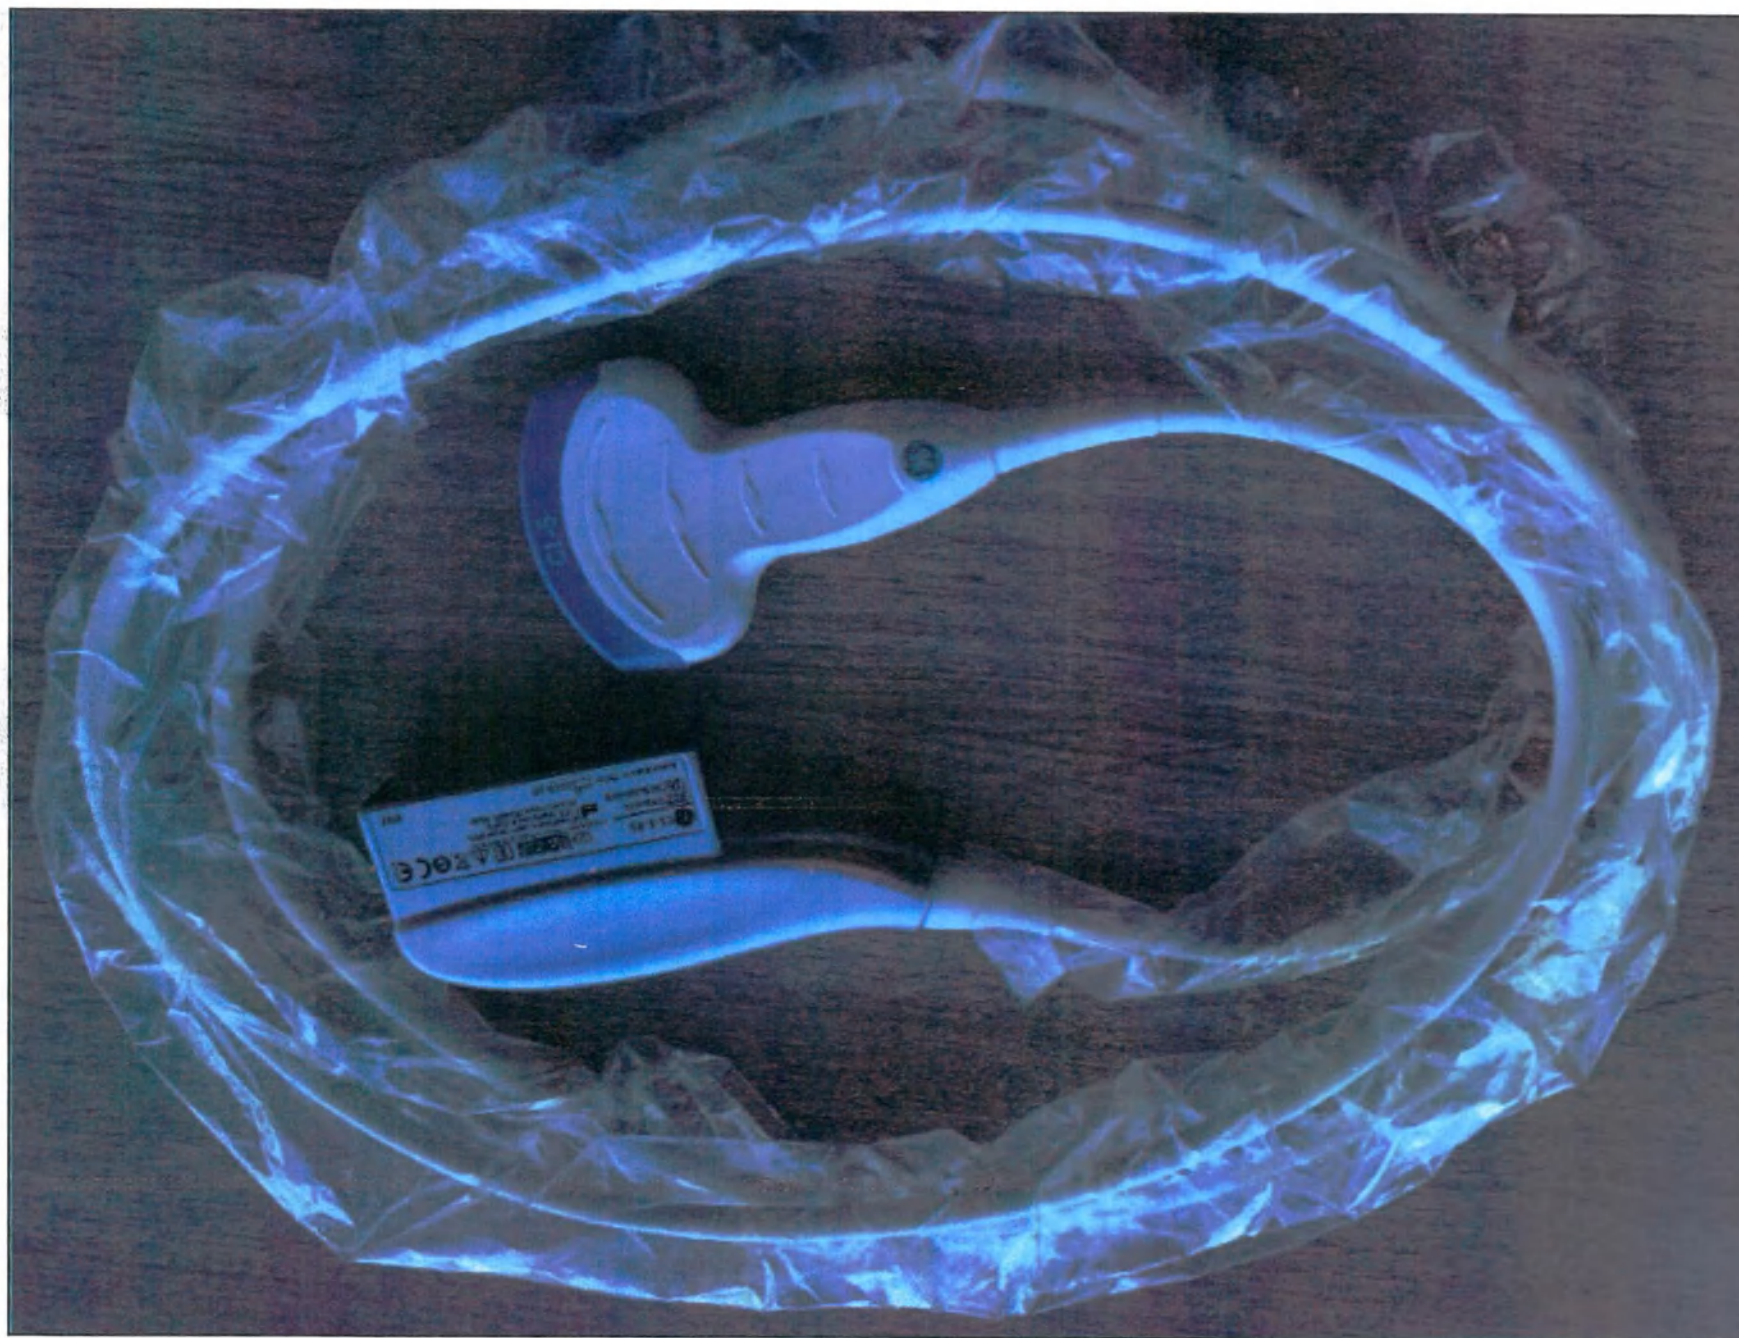


Датчик конвексный C1-5-RS

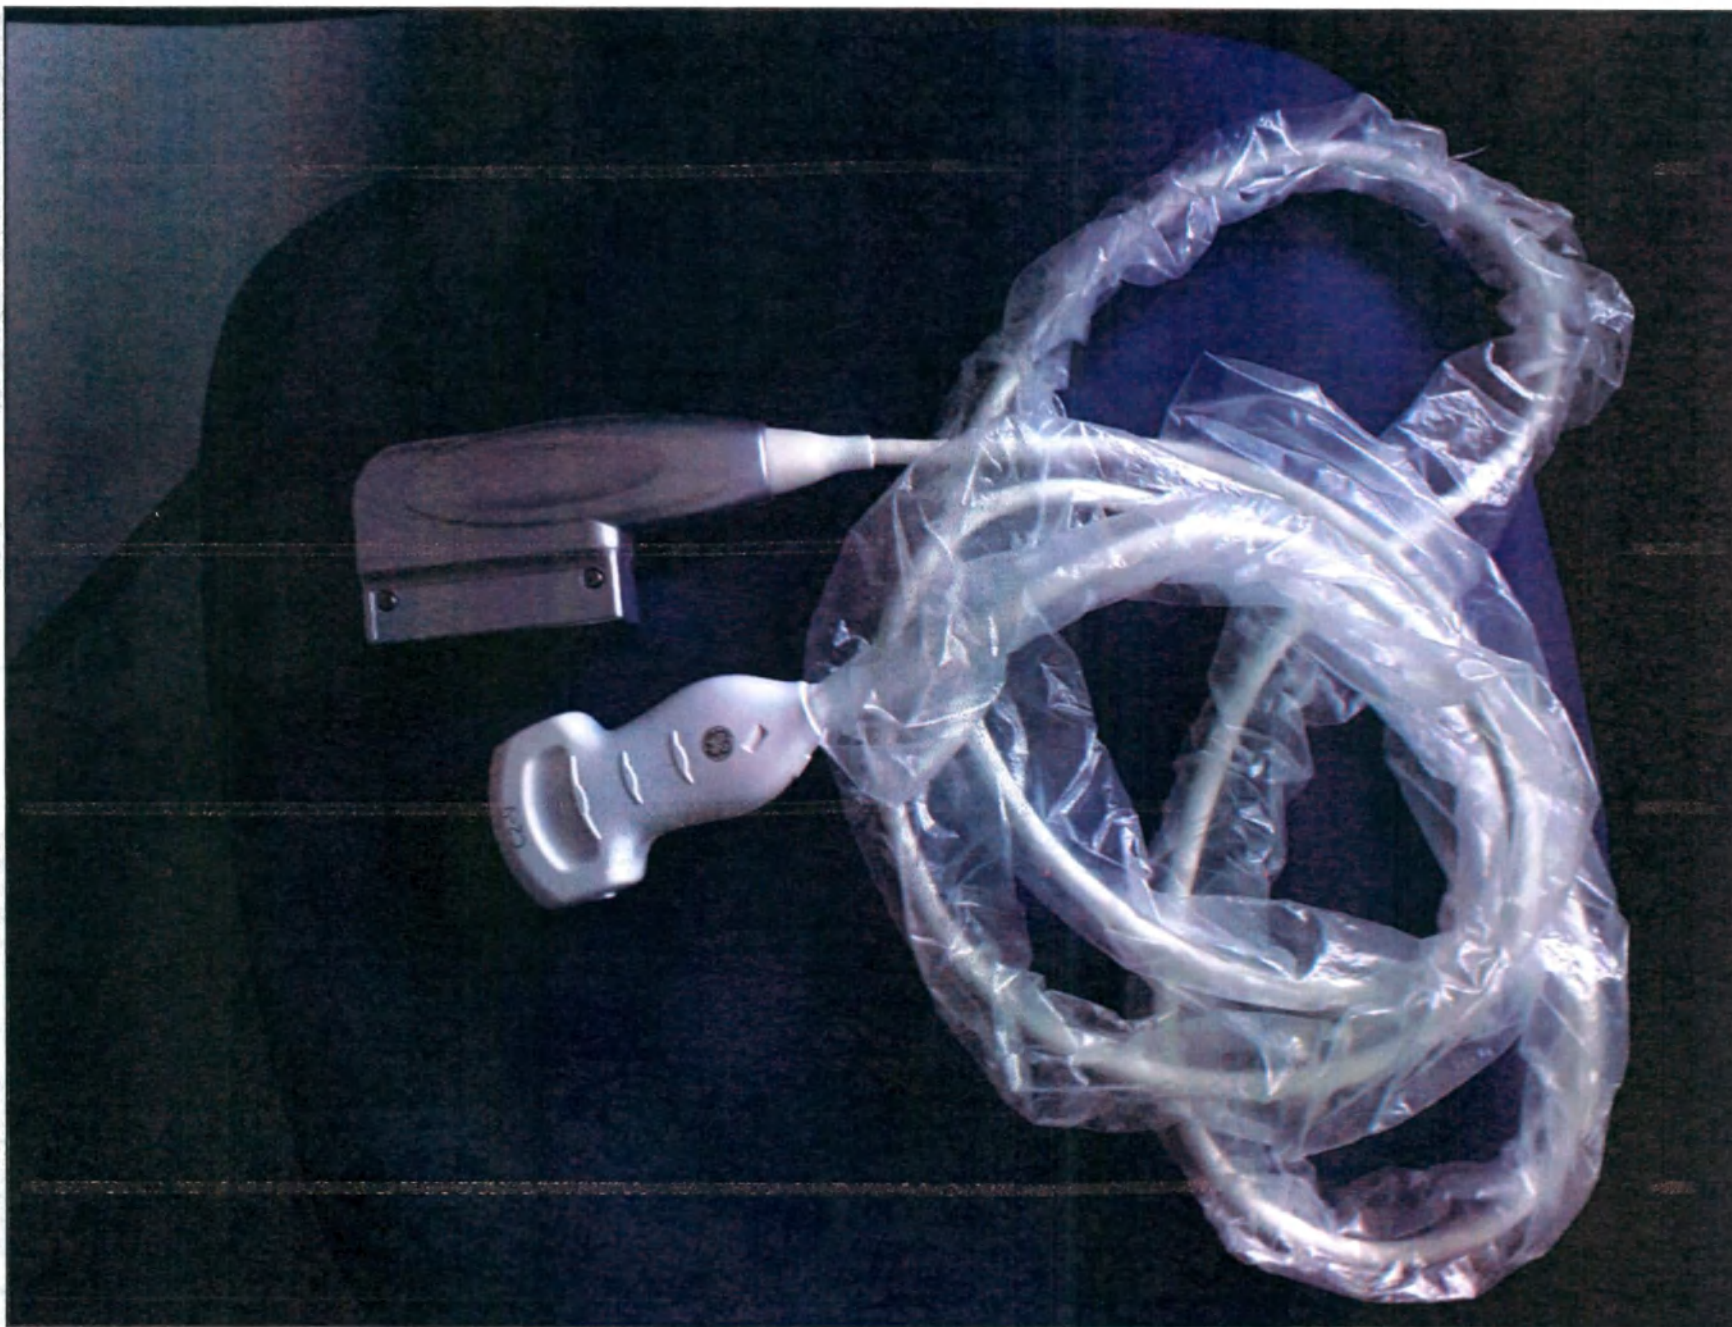


Датчик конвексный C2-9-RS




Датчик конвексный 8C-RS

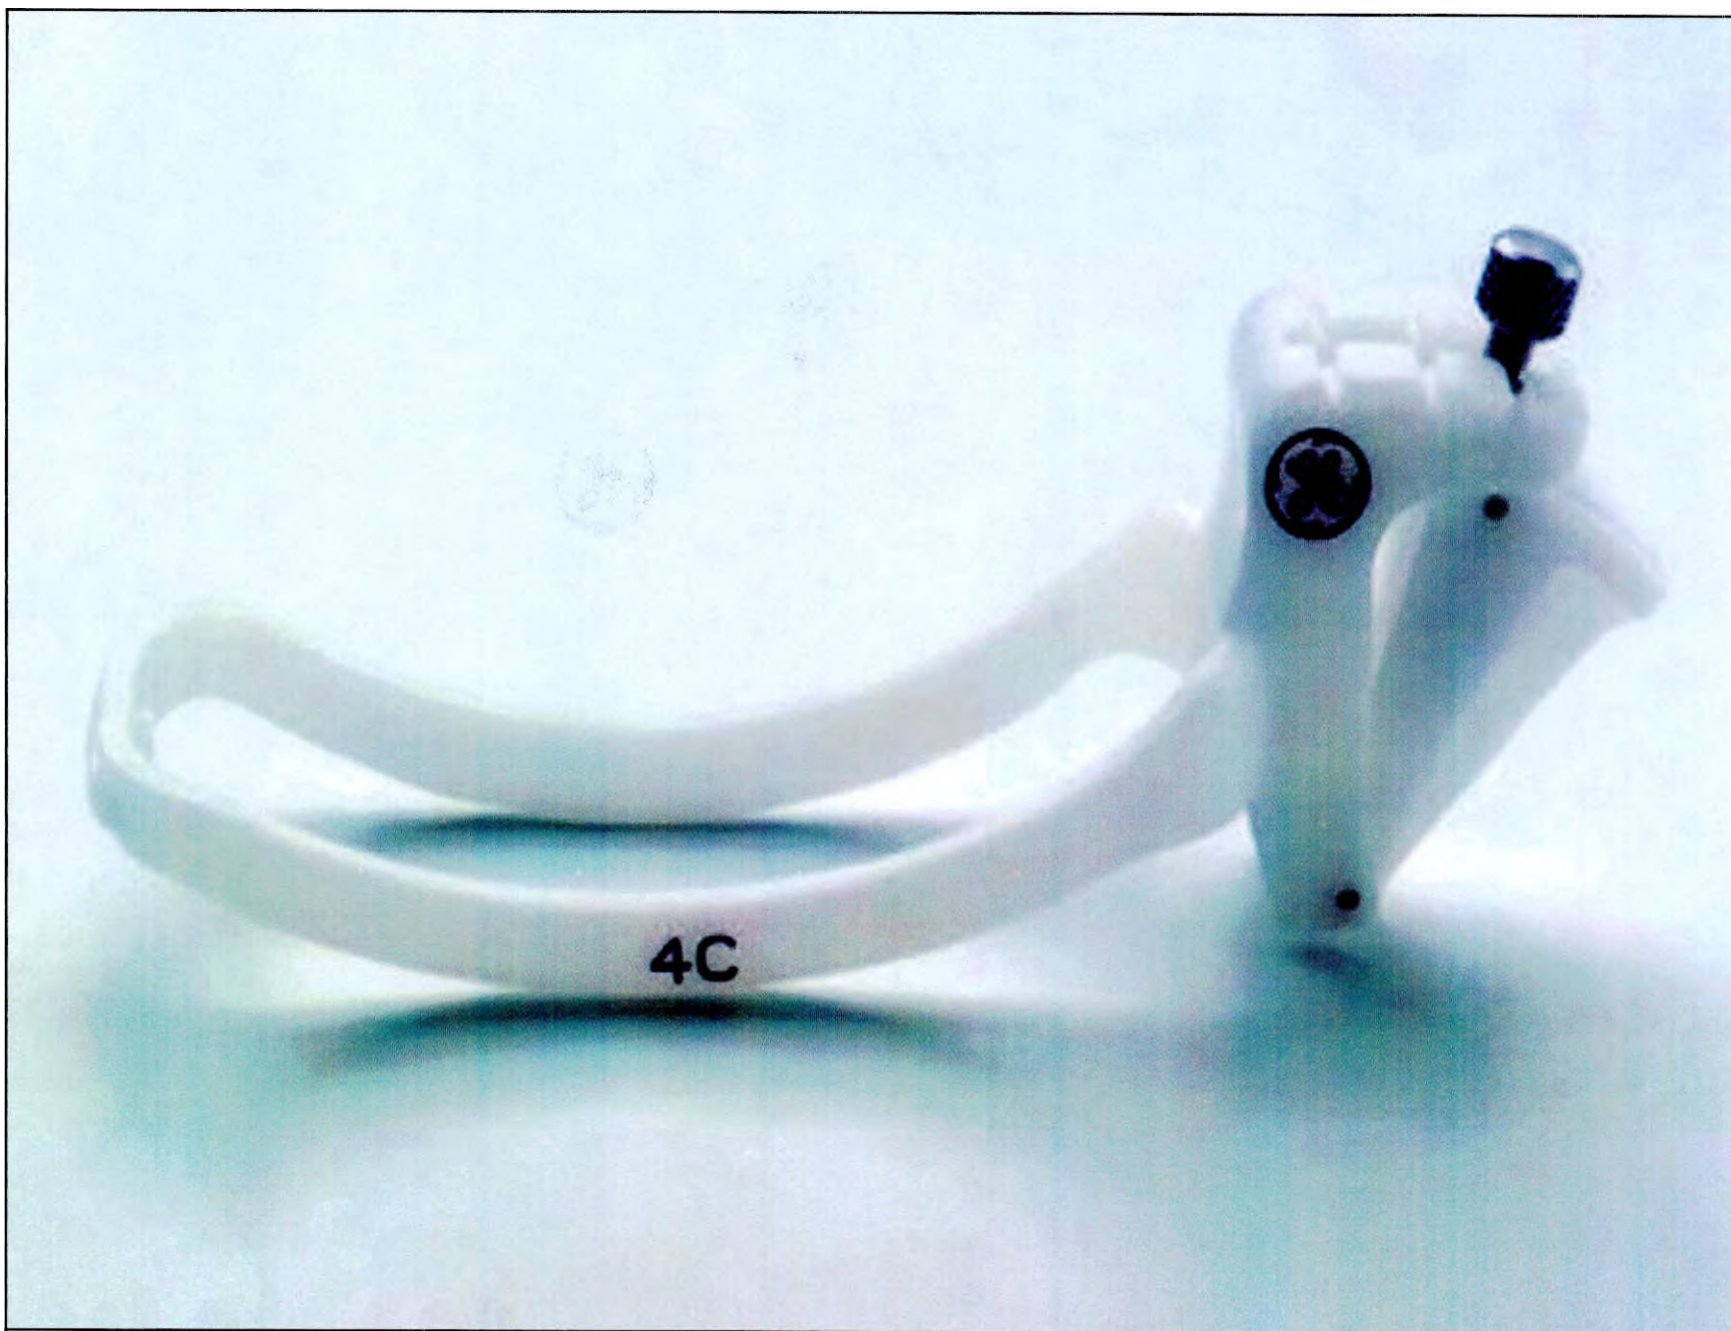

Биопсийные насадки для датчиков конвексных 4C-RS

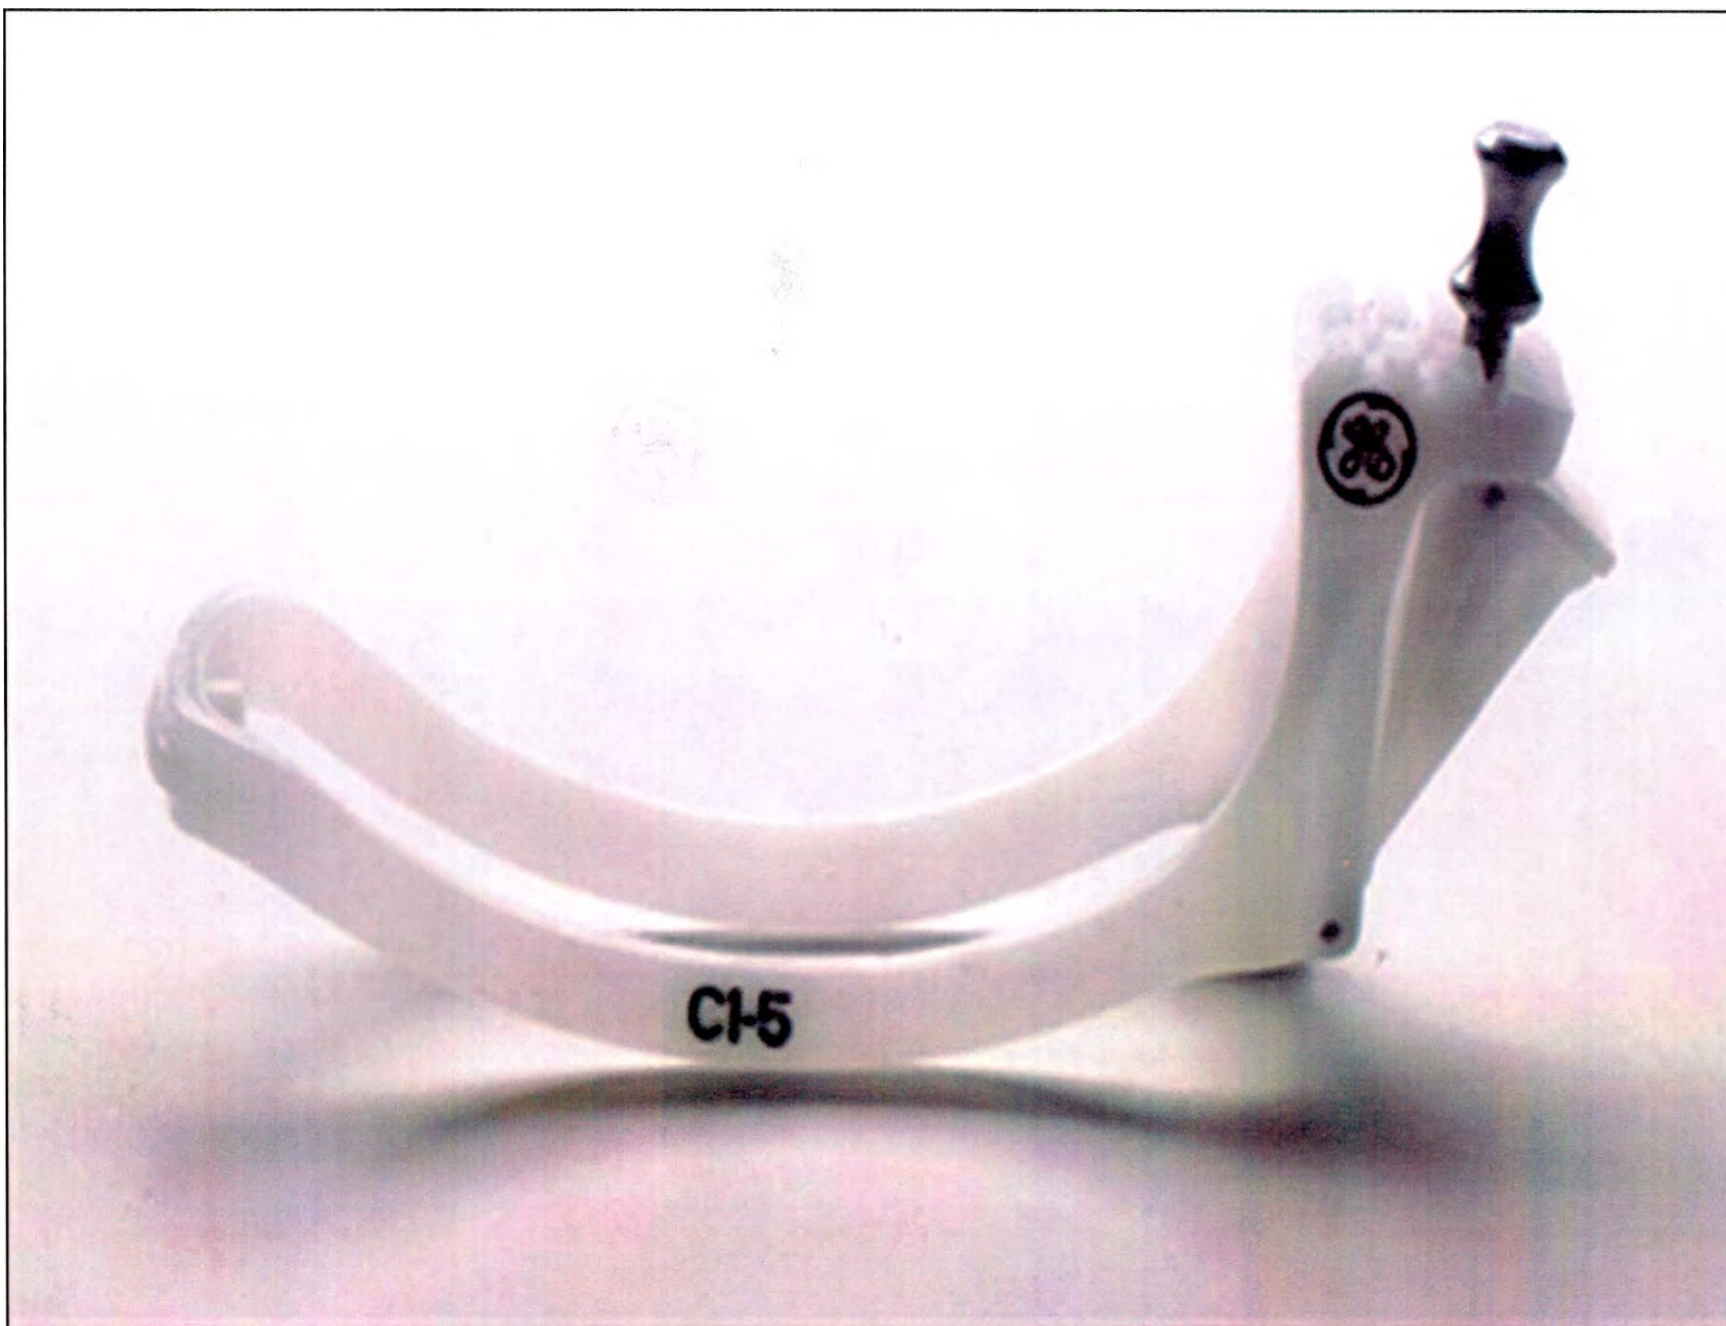

Биопсийные насадки для датчиков конвексных C1-5-RS

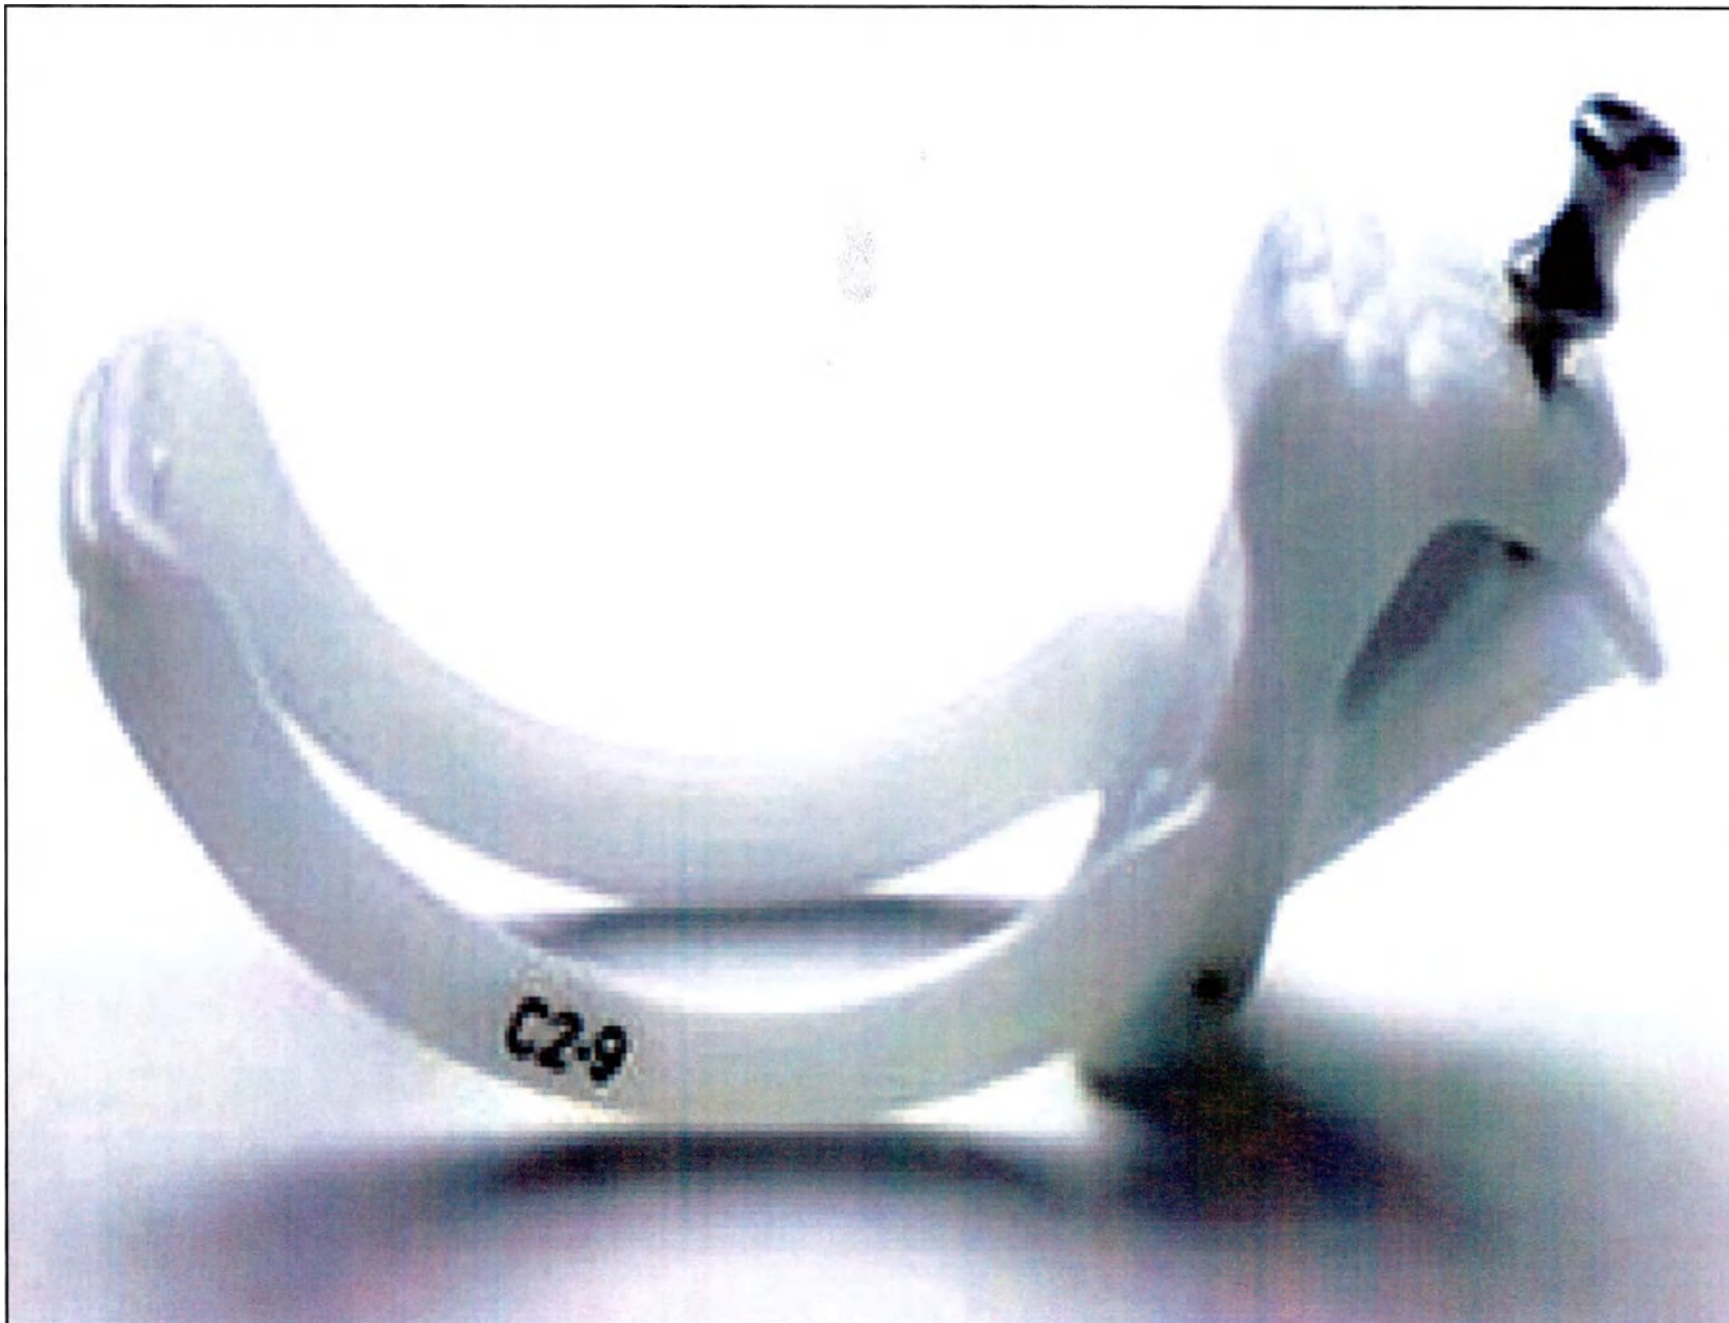

Биопсийные насадки для датчиков конвексных C2-9-RS



Датчик секторный фазированный 3Sc-RS



Датчик секторный фазированный 12S-RS




Биопсийные насадки для датчиков секторных 3Sc-RS




Датчик микроконвексный внутрисполостной E8C-RS



Биопсийные металлические насадки для датчиков микроконвексных E8C-RS

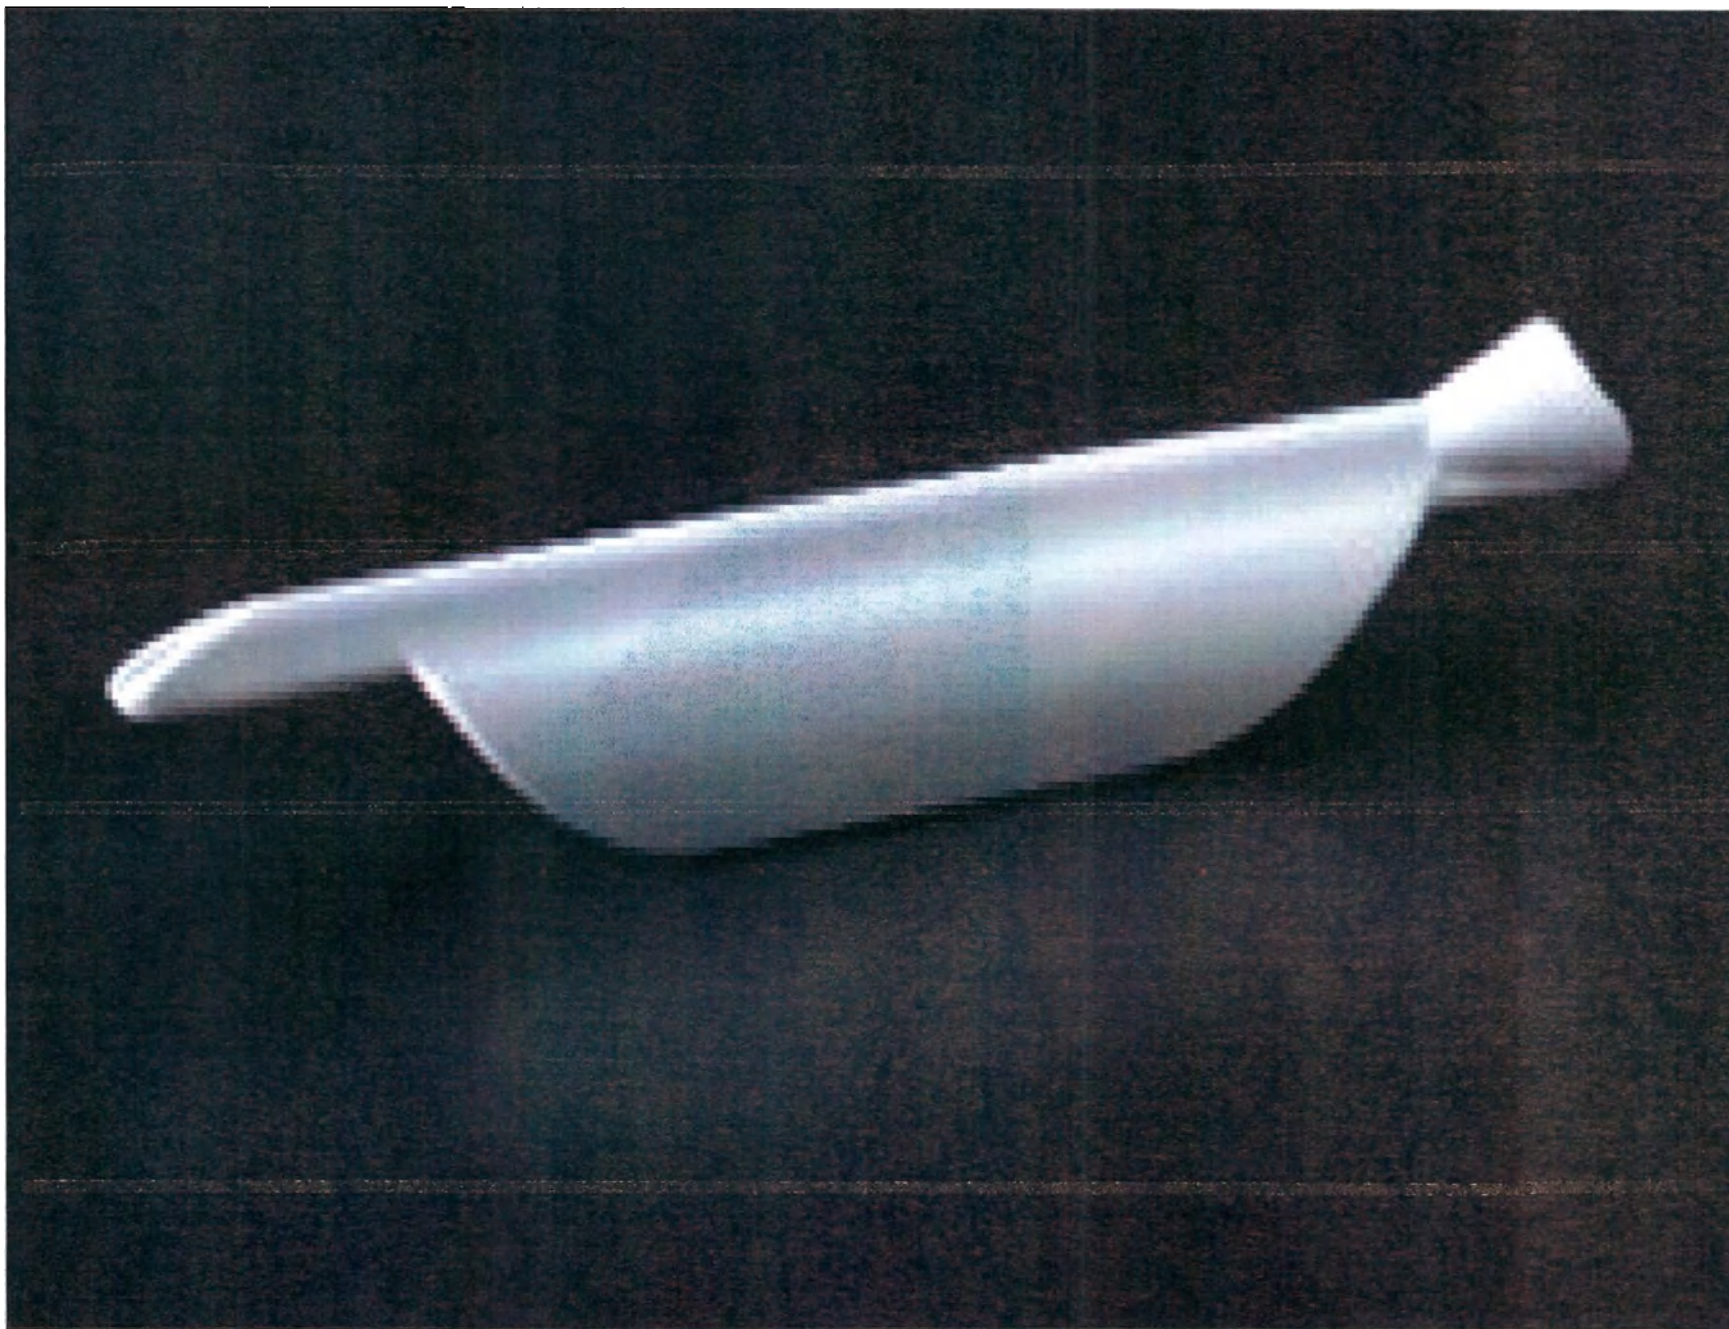


Биопсийные насадки для датчиков микроконвексных E8C-RS

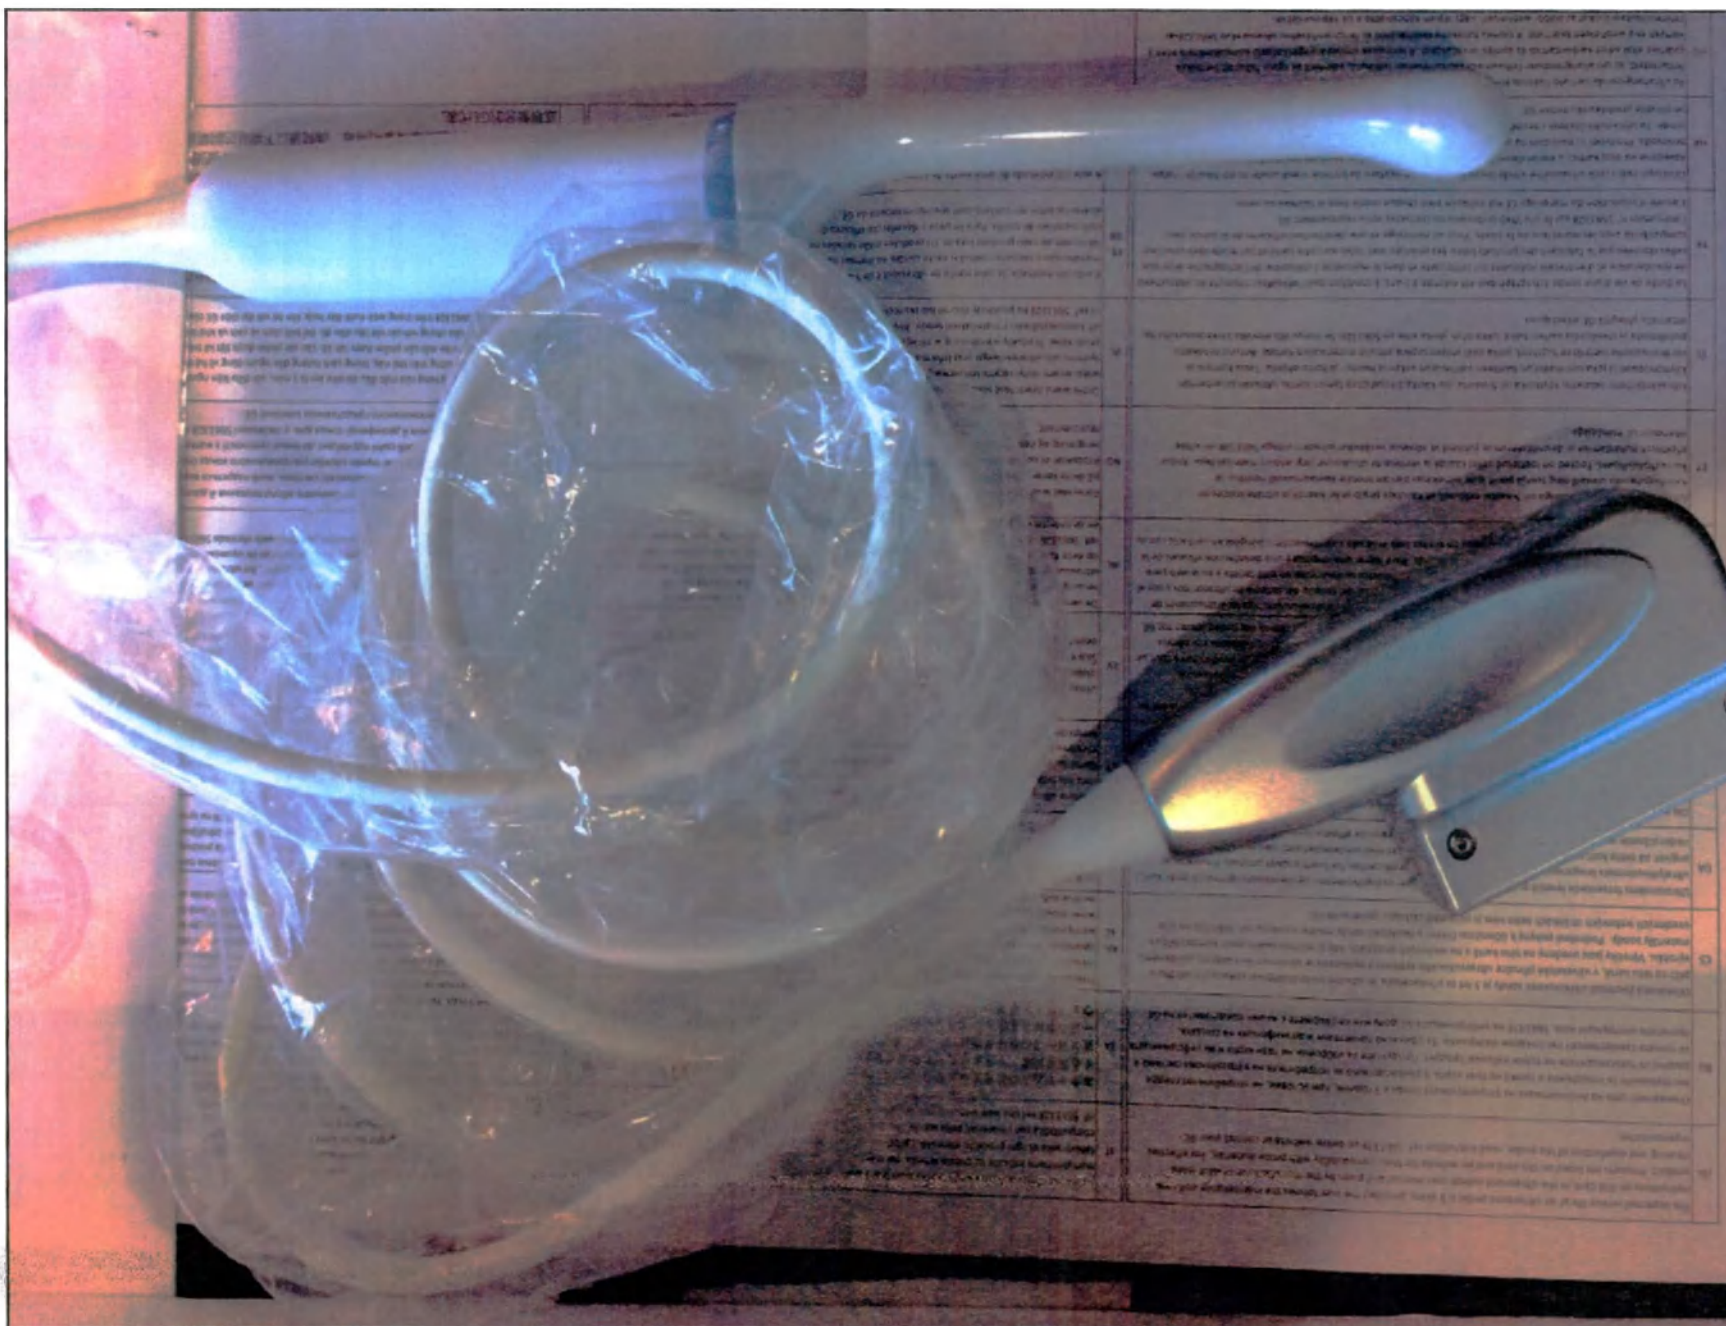

Датчик микроконвексный внутриполостной IC9-RS



Биопсийные насадки для датчиков микроконвексных IC9-RS

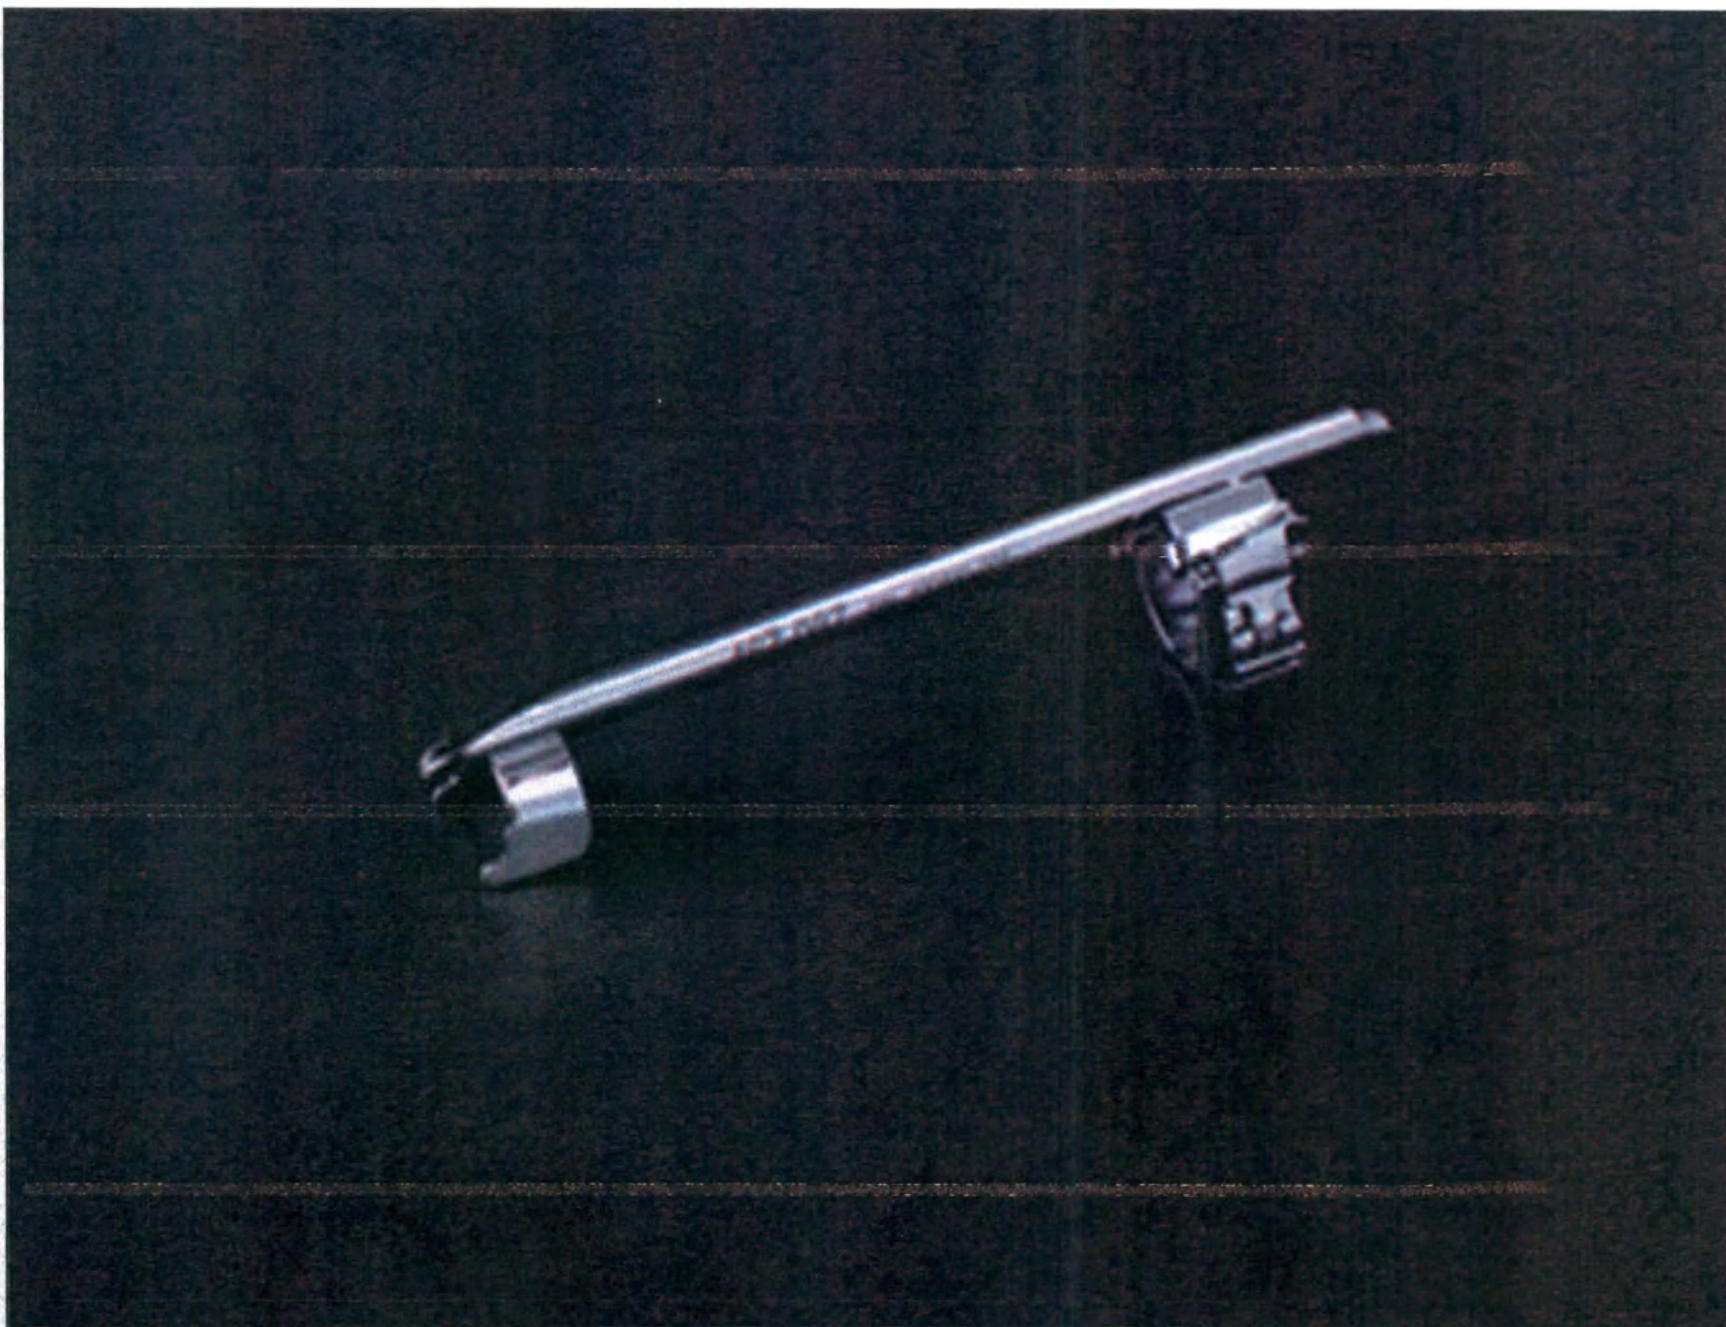

Биопсийные металлические насадки для датчиков микроконвексных IC9-RS




Датчик объемный конвексный RAB6-RS




Биопсийные металлические насадки для датчиков объемных конвексных RAB6-RS




Биопсийные насадки для датчиков конвексных RAB6-RS

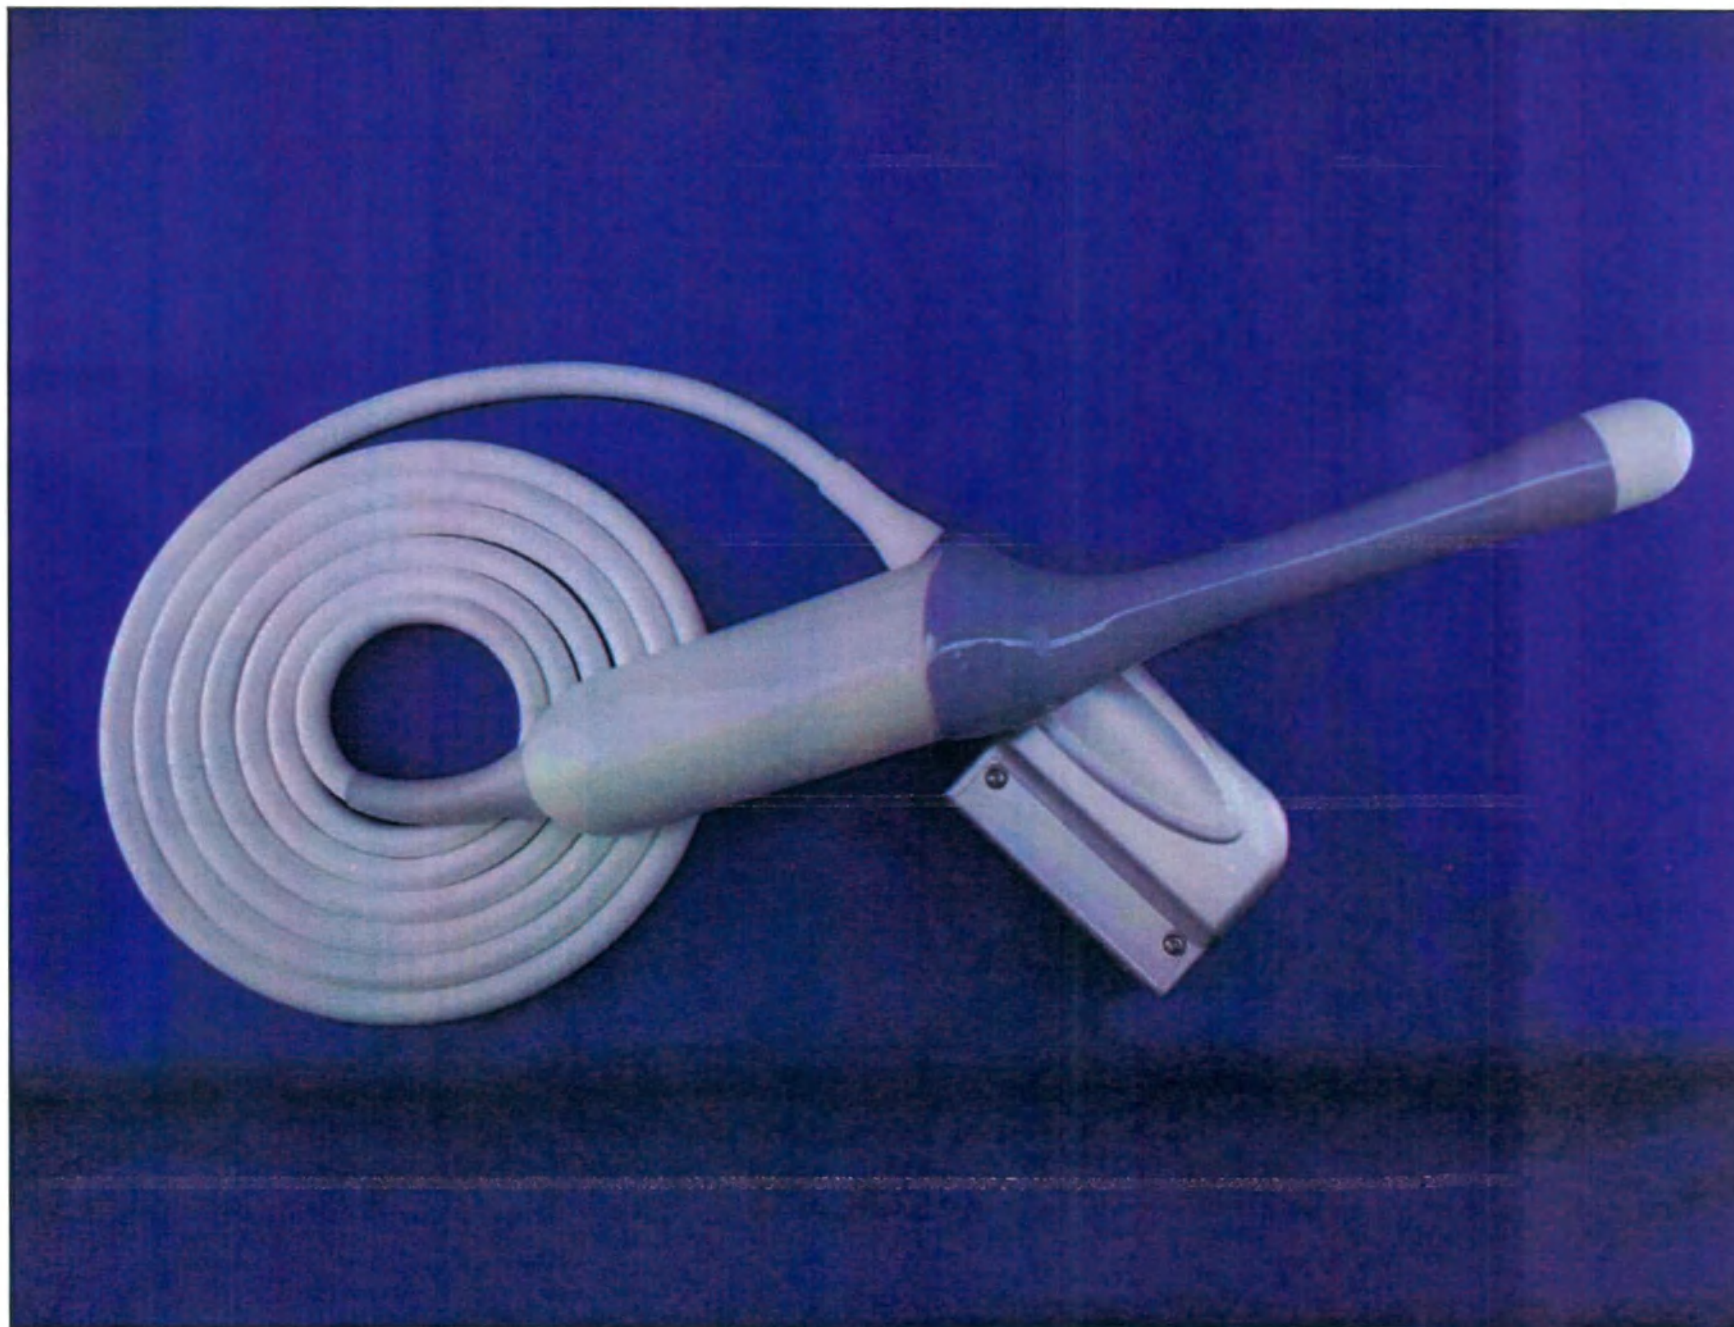

Датчик объемный внутриполостной микроконвексный RIC5-9A-RS

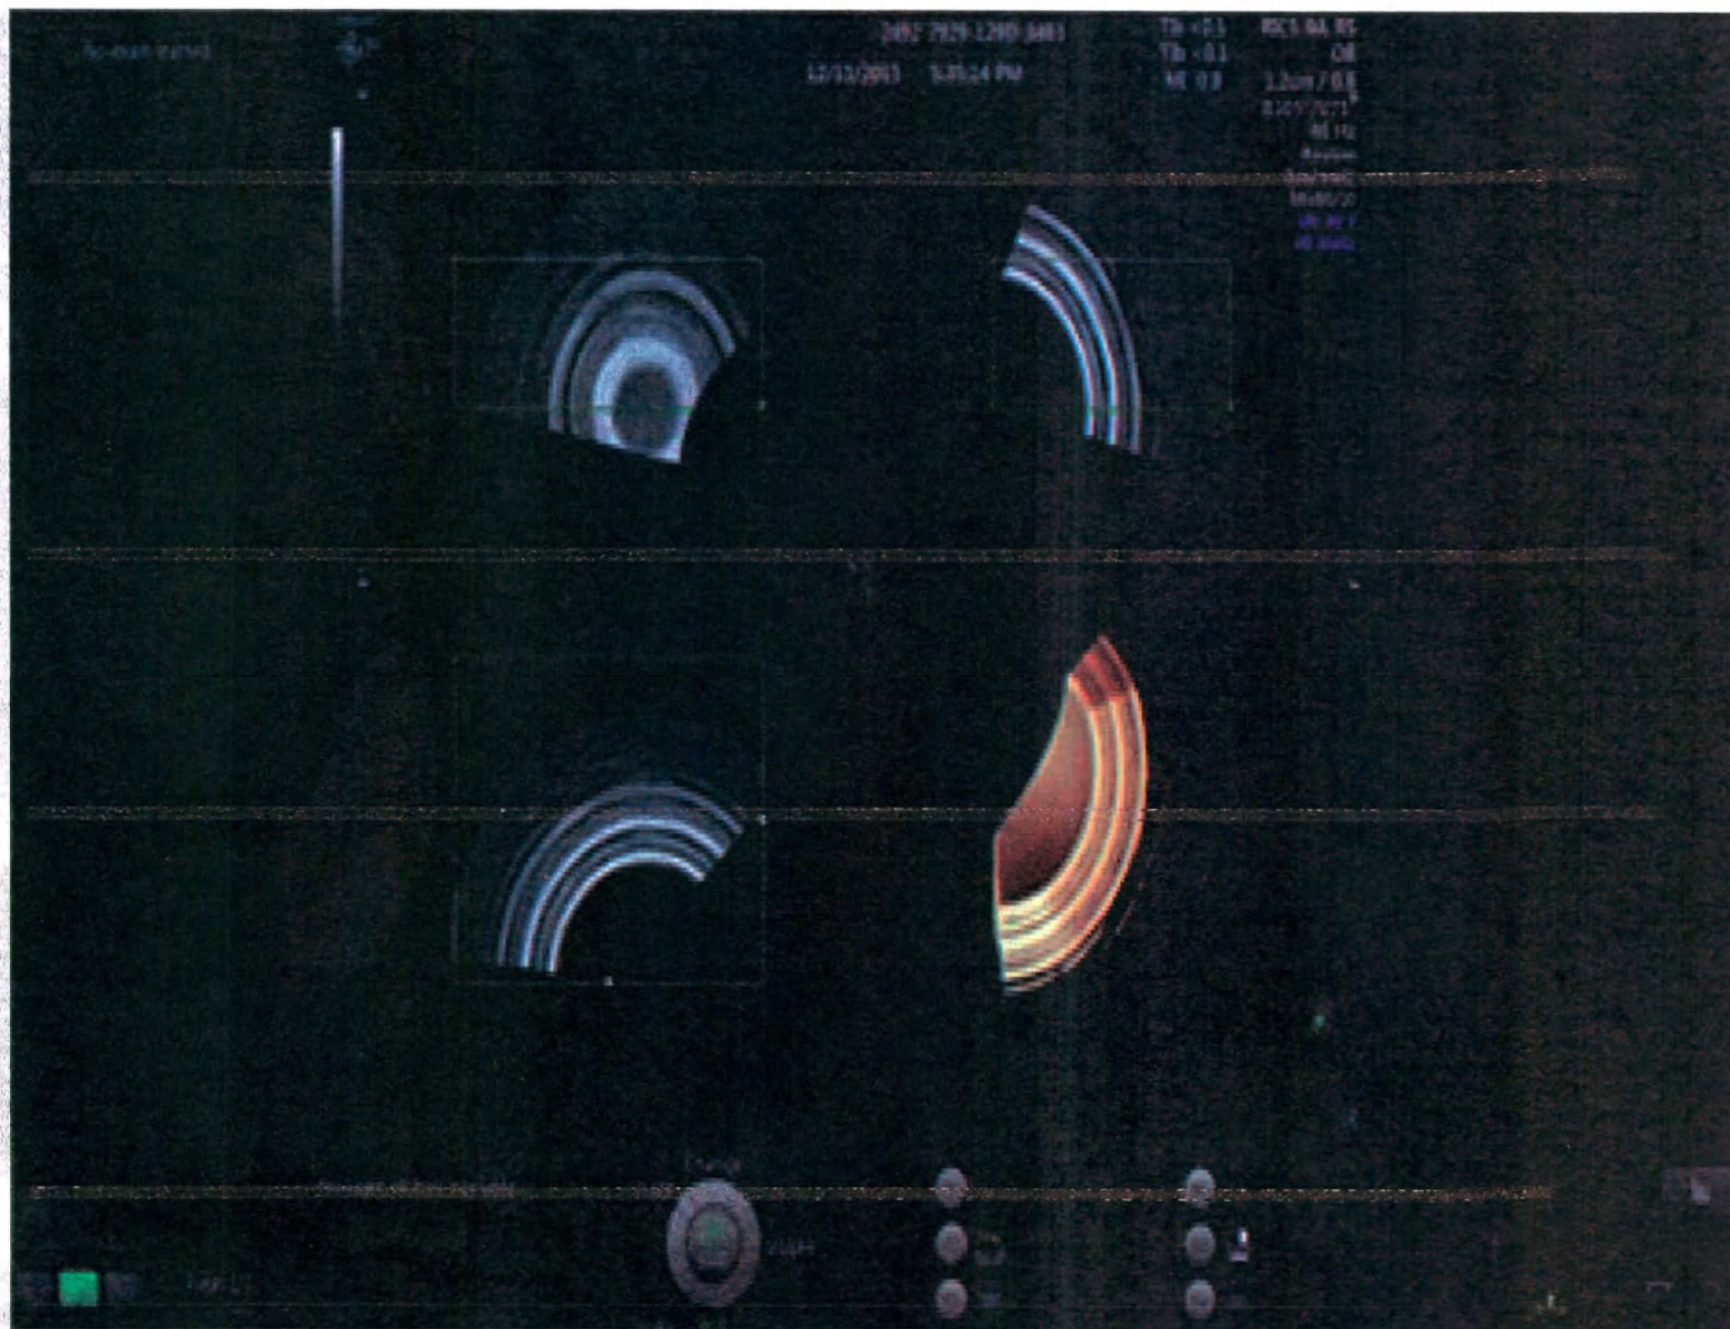


Модуль встроенный для работы с объемными 3D/4D изображениями, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

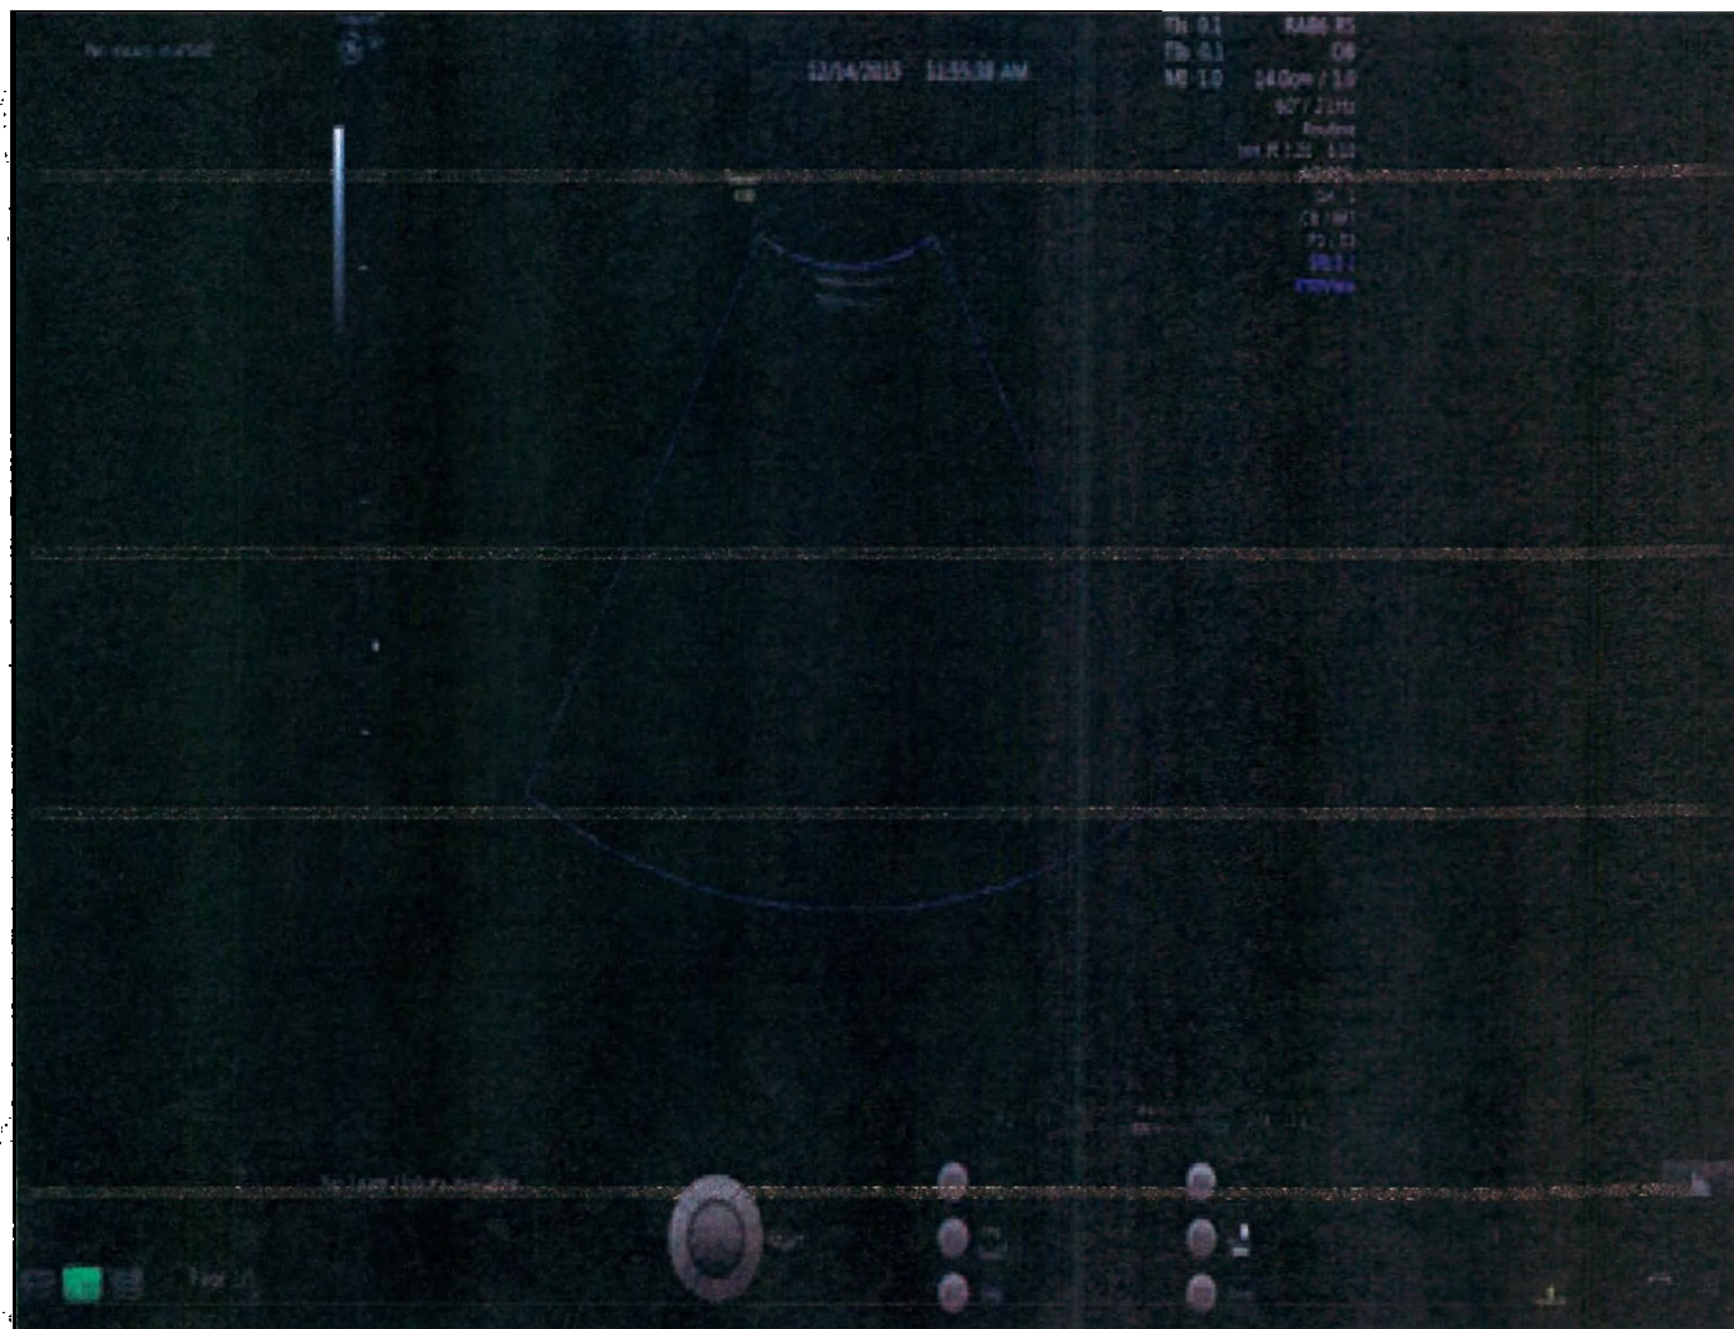

Модуль встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме панорамного сканирования, активируемый электронным

носителем (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

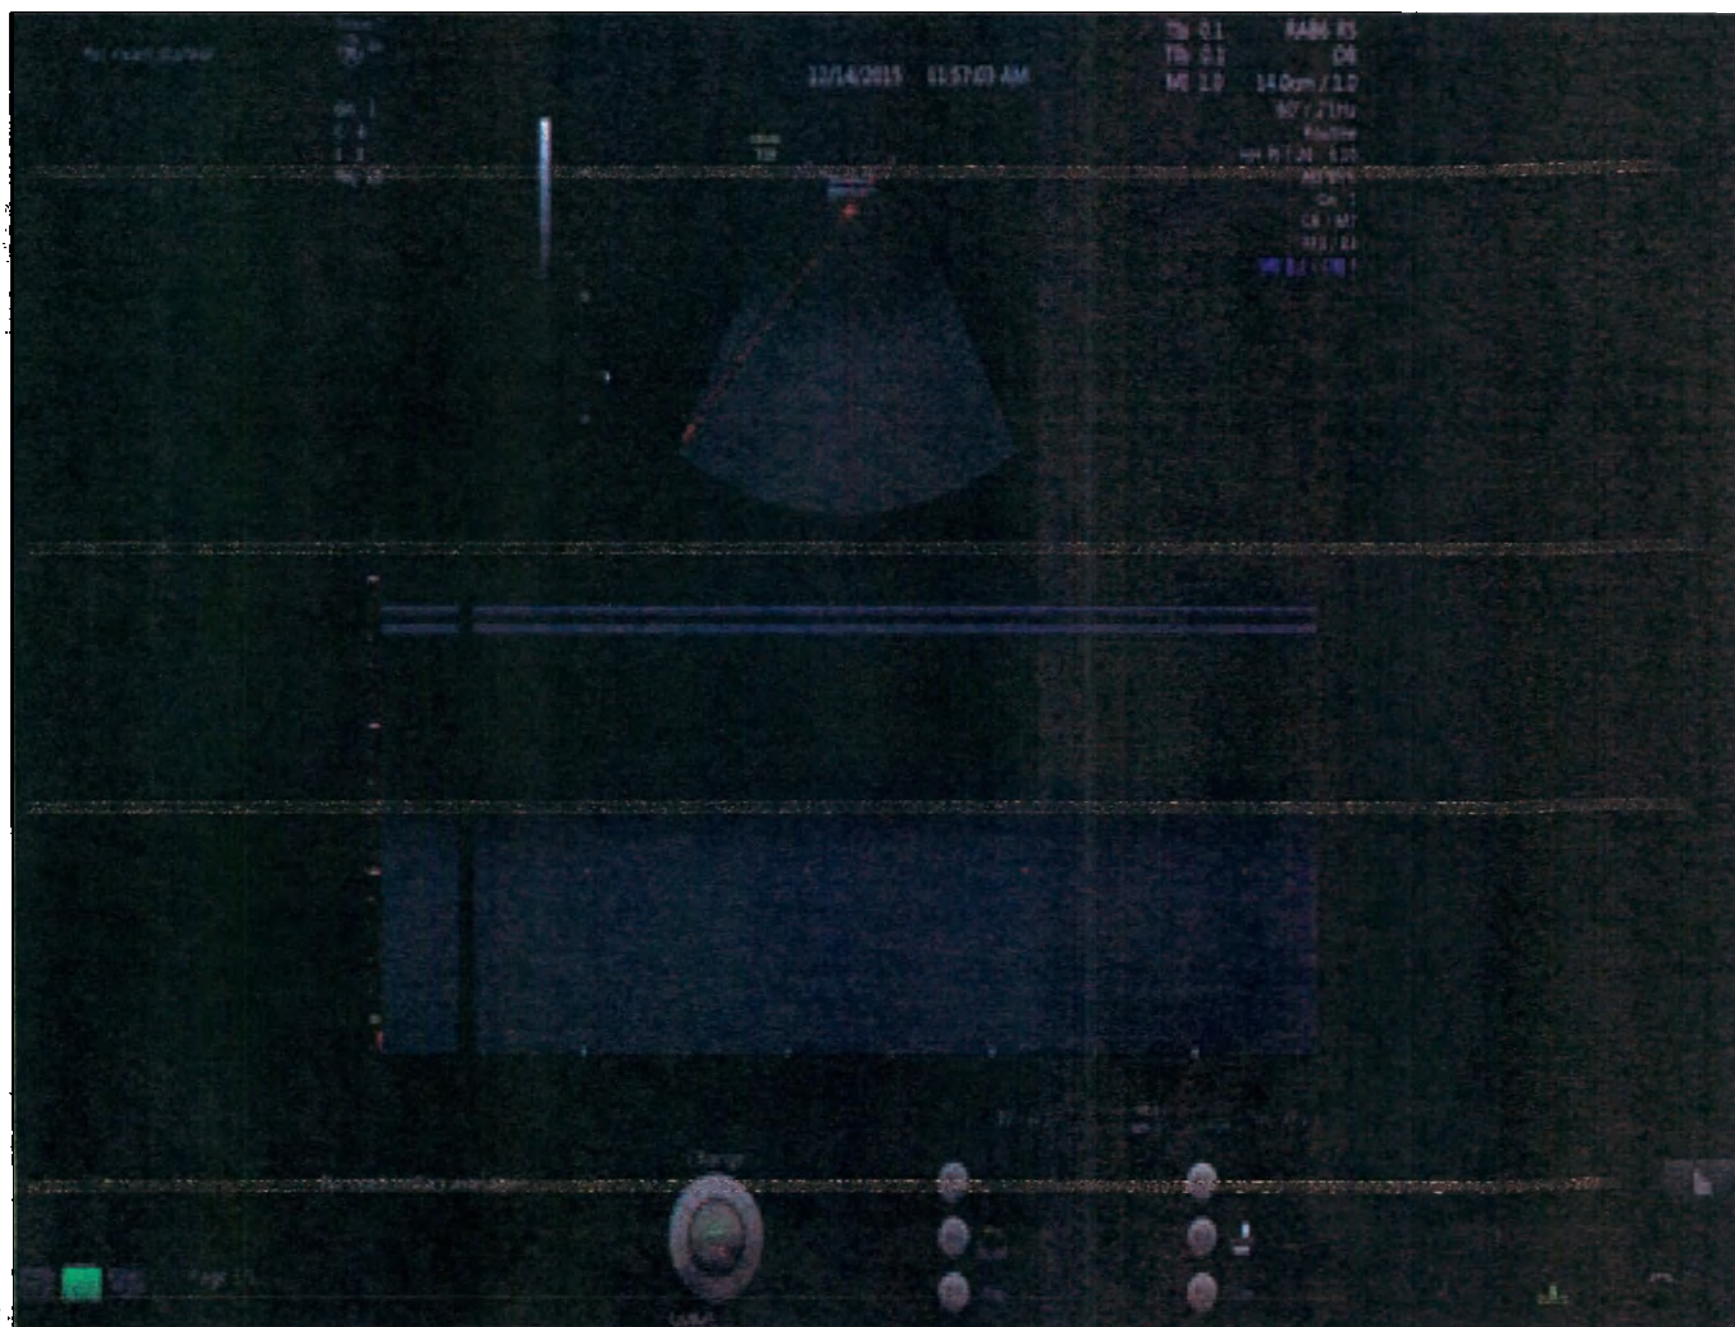

Модуль встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме анатомического М-режима, активируемый электронным

носителем (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

Source: **DICOM Server** Search: **Patient Name** **B** **Query Patients**

☒ Patients & Exams ☐ Exams Only **Exam Date** **10.06.2007** **AND**

Patients


B	Patient ID	Patient Name	Birthdate	E	Sex	Last Exam
	3D-06, 3D HD-Flow	Bauer Andrea Alexandra	12.10.1980	2	F	26.07.2006

Query Exams

Exams

B	Exam Date	Exam Time	Exam Type	M	Img	Exam Comment	Exam Comment
	26.07.2006	12:06:45	etype2	N	2		
	26.07.2006	12:06:45	ex2 1img	N	1		

Retrieve Images

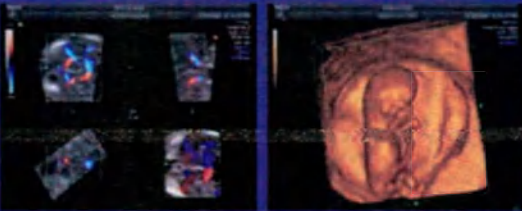

Модуль встроенный для обеспечения возможности передачи данных DICOM, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или




Модуль встроенный для автоматического измерения толщины воротникового пространства, активируемый электронным ключом на бумажном носителе (или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Модуль встроенный для автоматического измерения структур плода, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

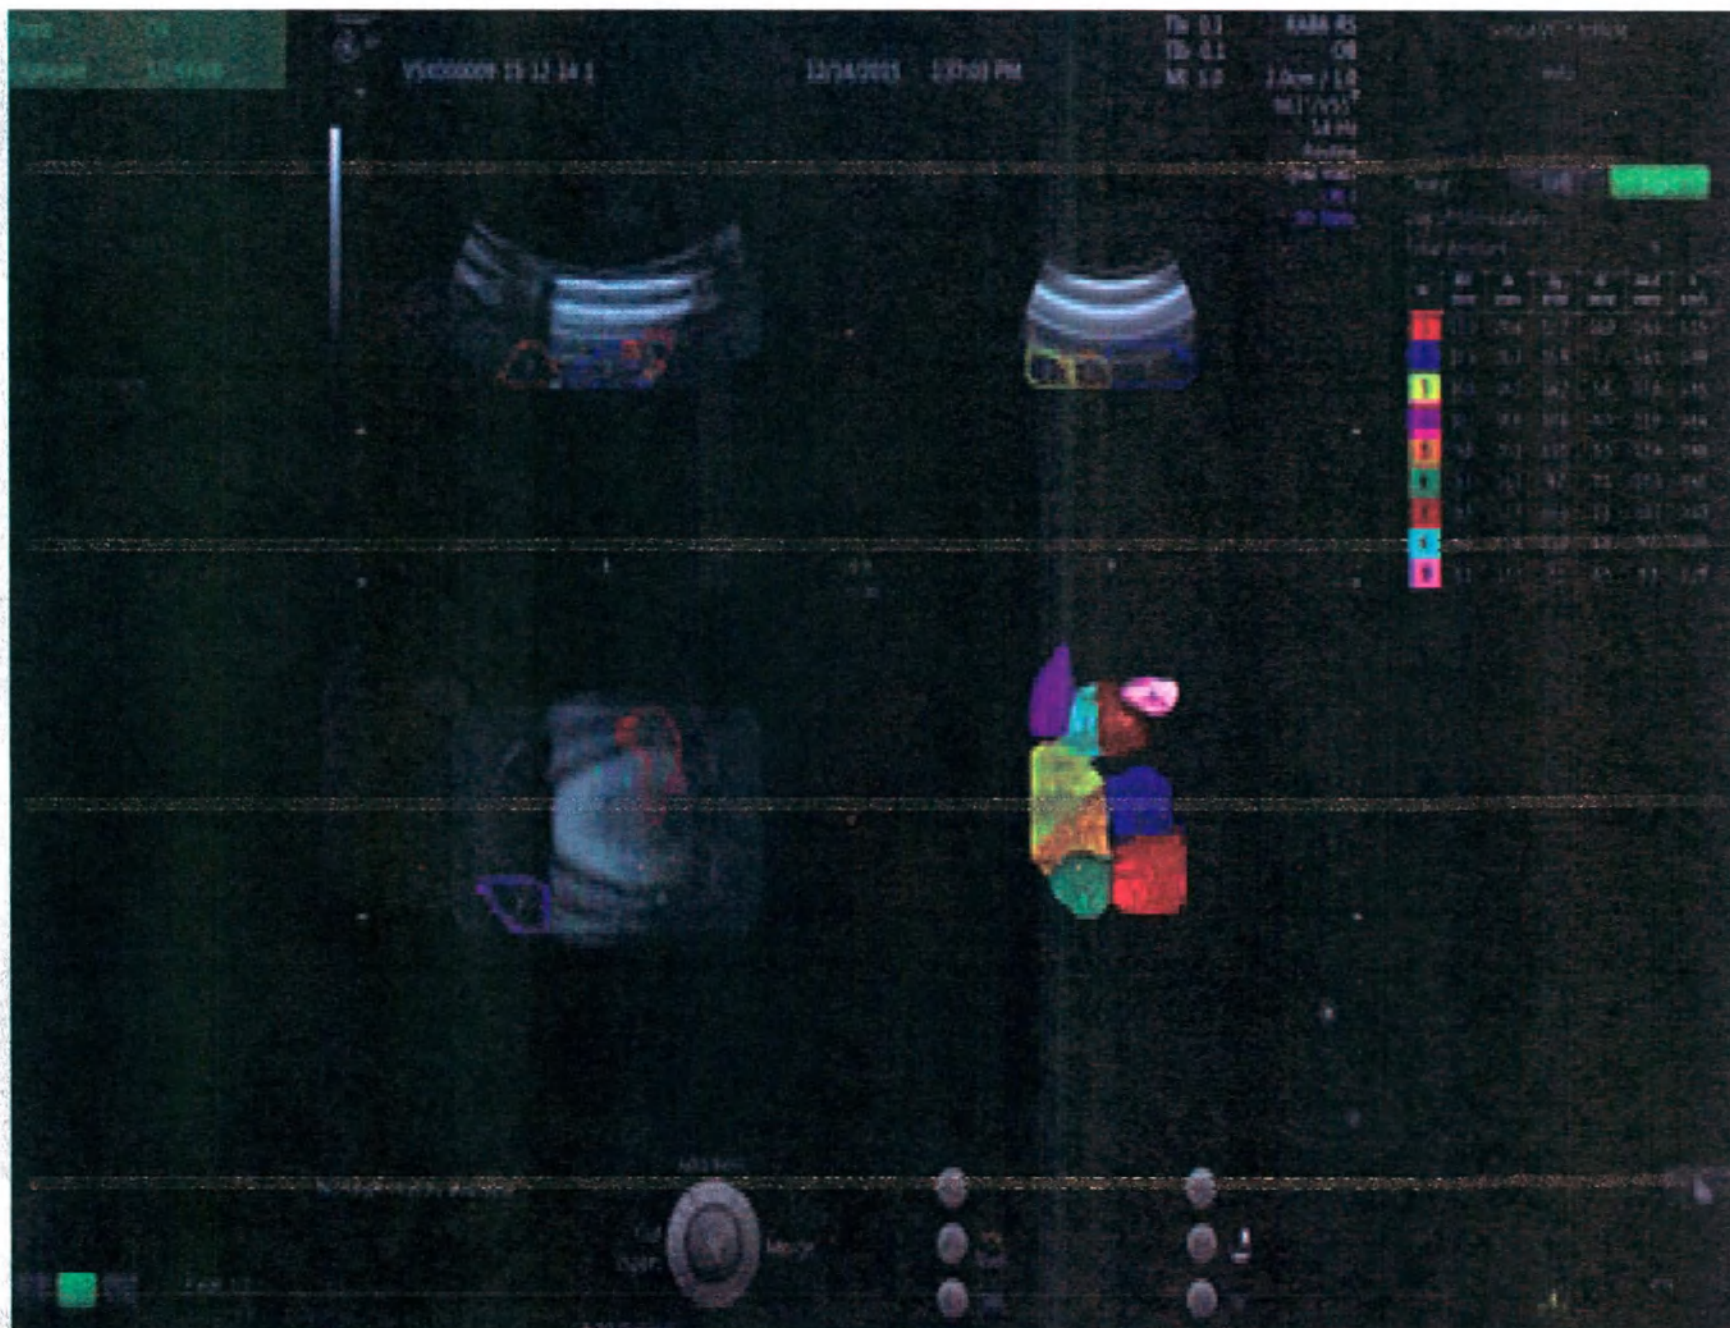

Модуль встроенный для автоматического распознавания структур низкой экзогенности, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или

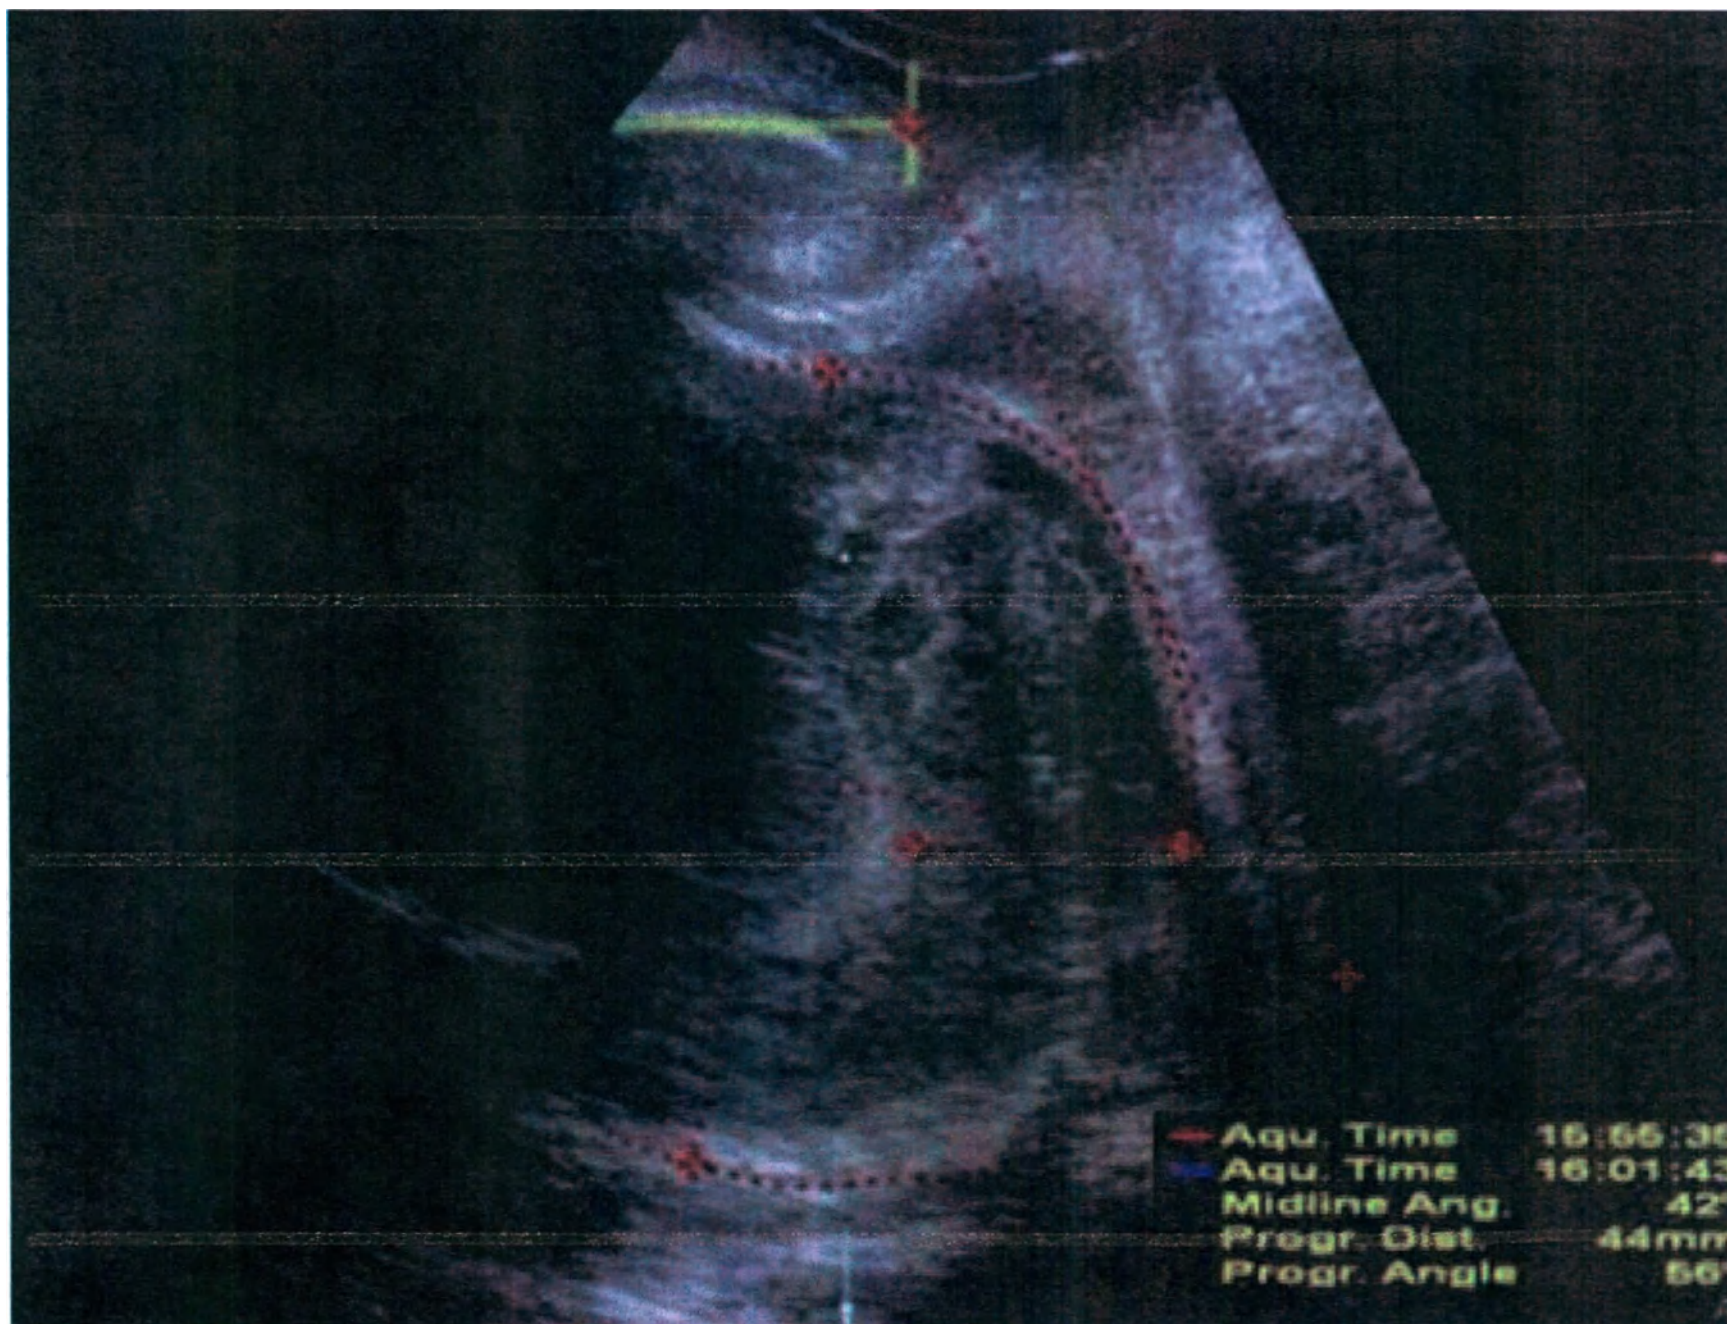

Модуль встроенный для компьютерного диагностического анализа эффективности родовой деятельности в режиме объемной эхографии, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

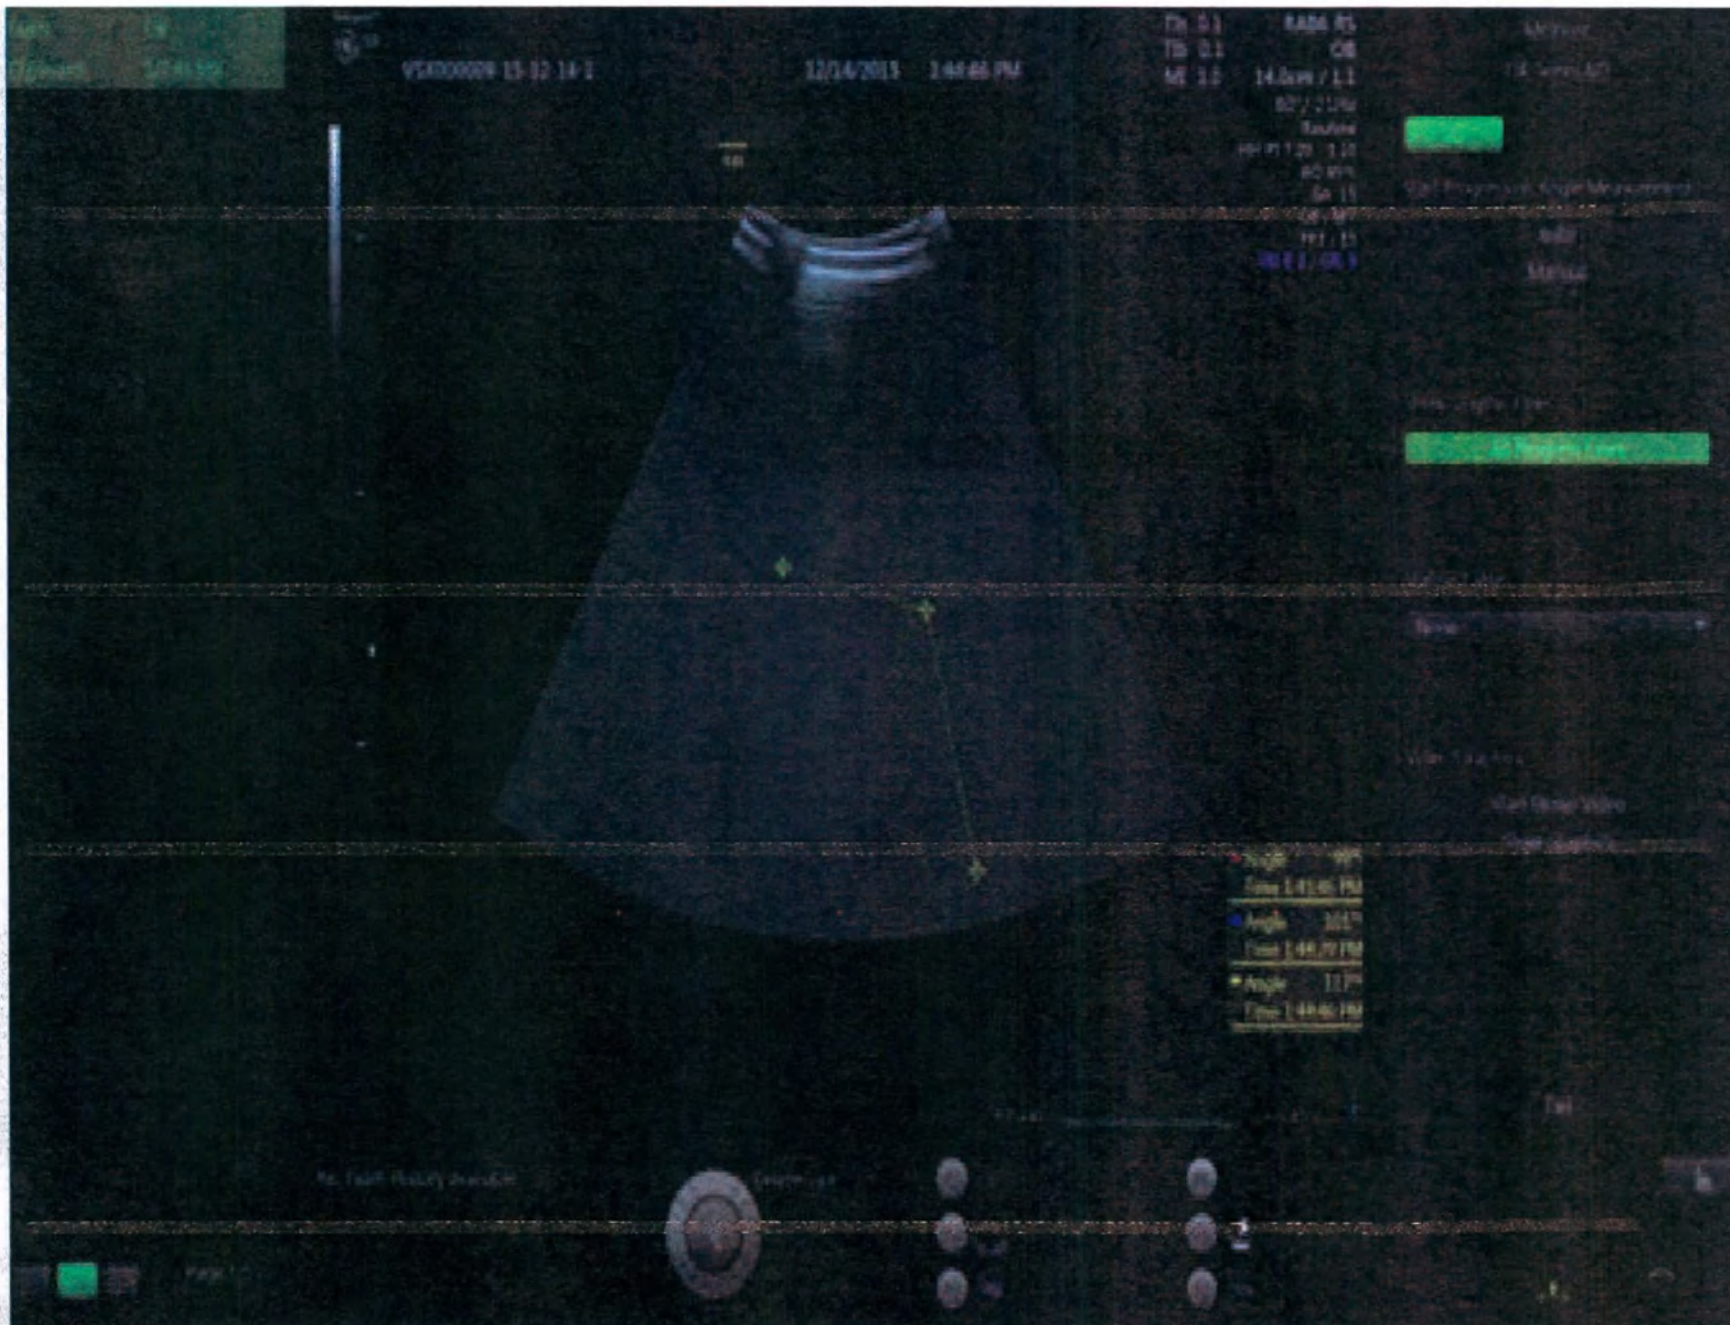


Модуль встроенный для компьютерного диагностического анализа эффективности родовой деятельности в режиме двумерной эхографии, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




Модуль встроенный для объемного изображения с использованием виртуального источника света, активируемый электронным ключом на


базе ЦИРМИ (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

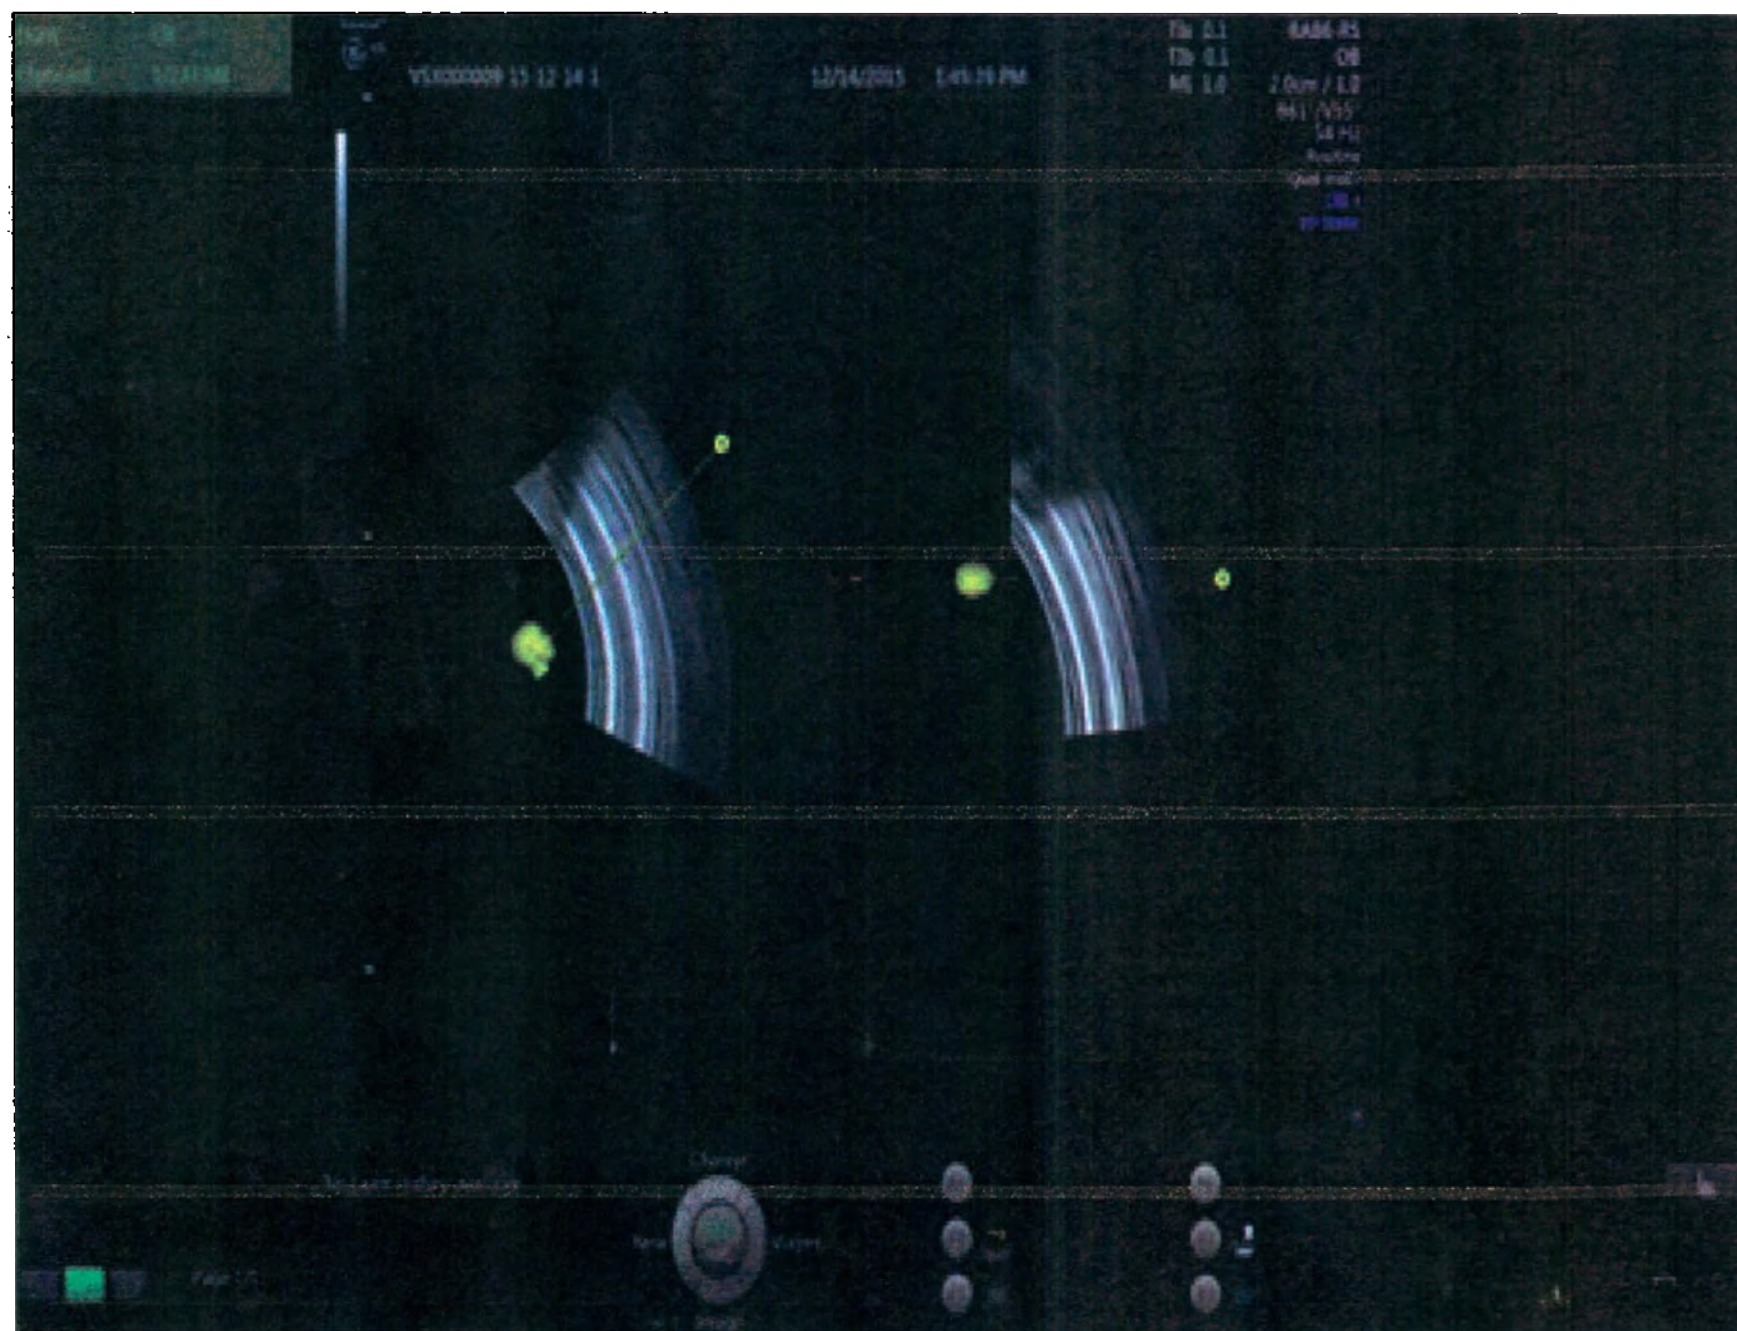

Модуль встроенный для дополнительной объемной контрастной визуализации в режиме 3D/4D, активируемый электронным ключом на бумажном носителе (или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

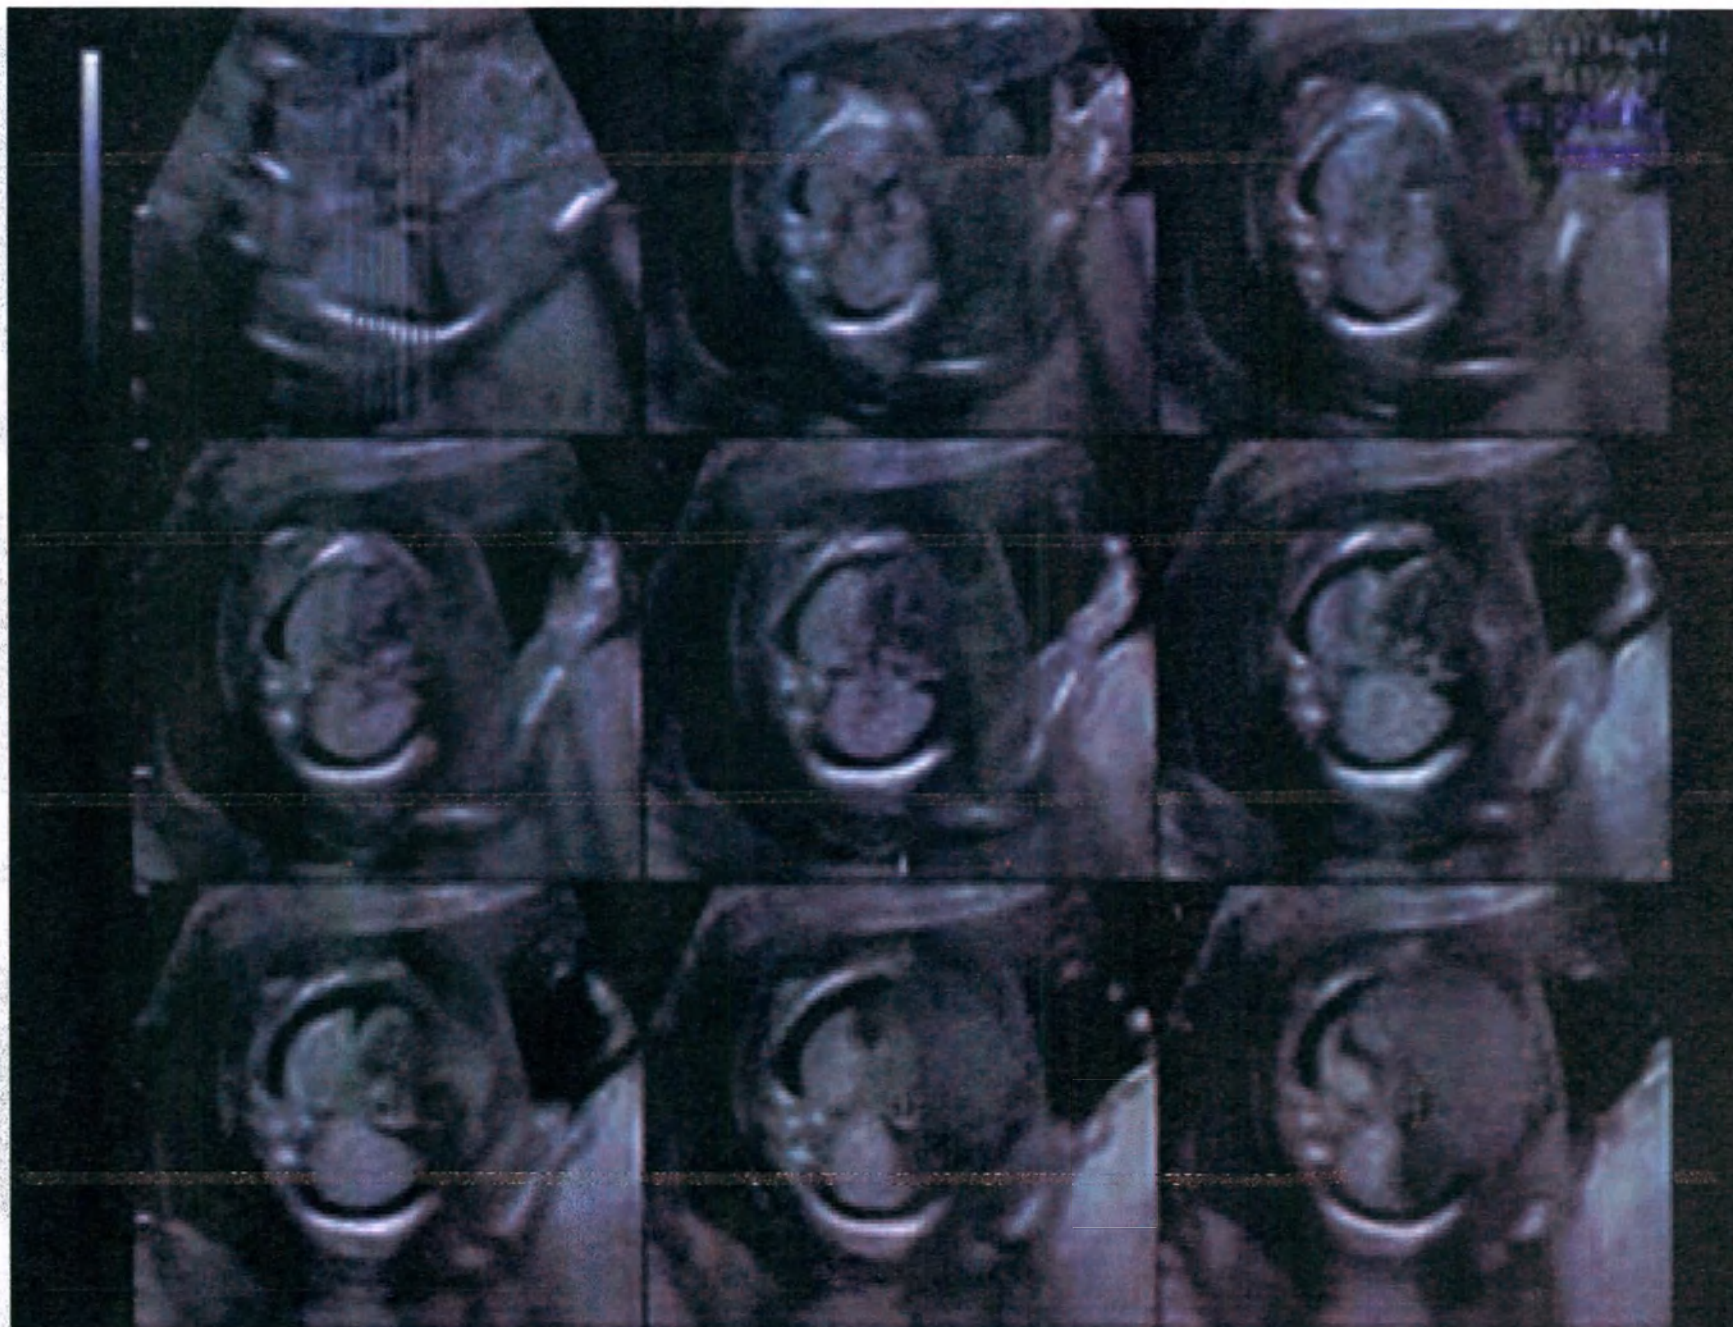


Модуль встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме ультразвуковой томографии, активируемый электронным носителем (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

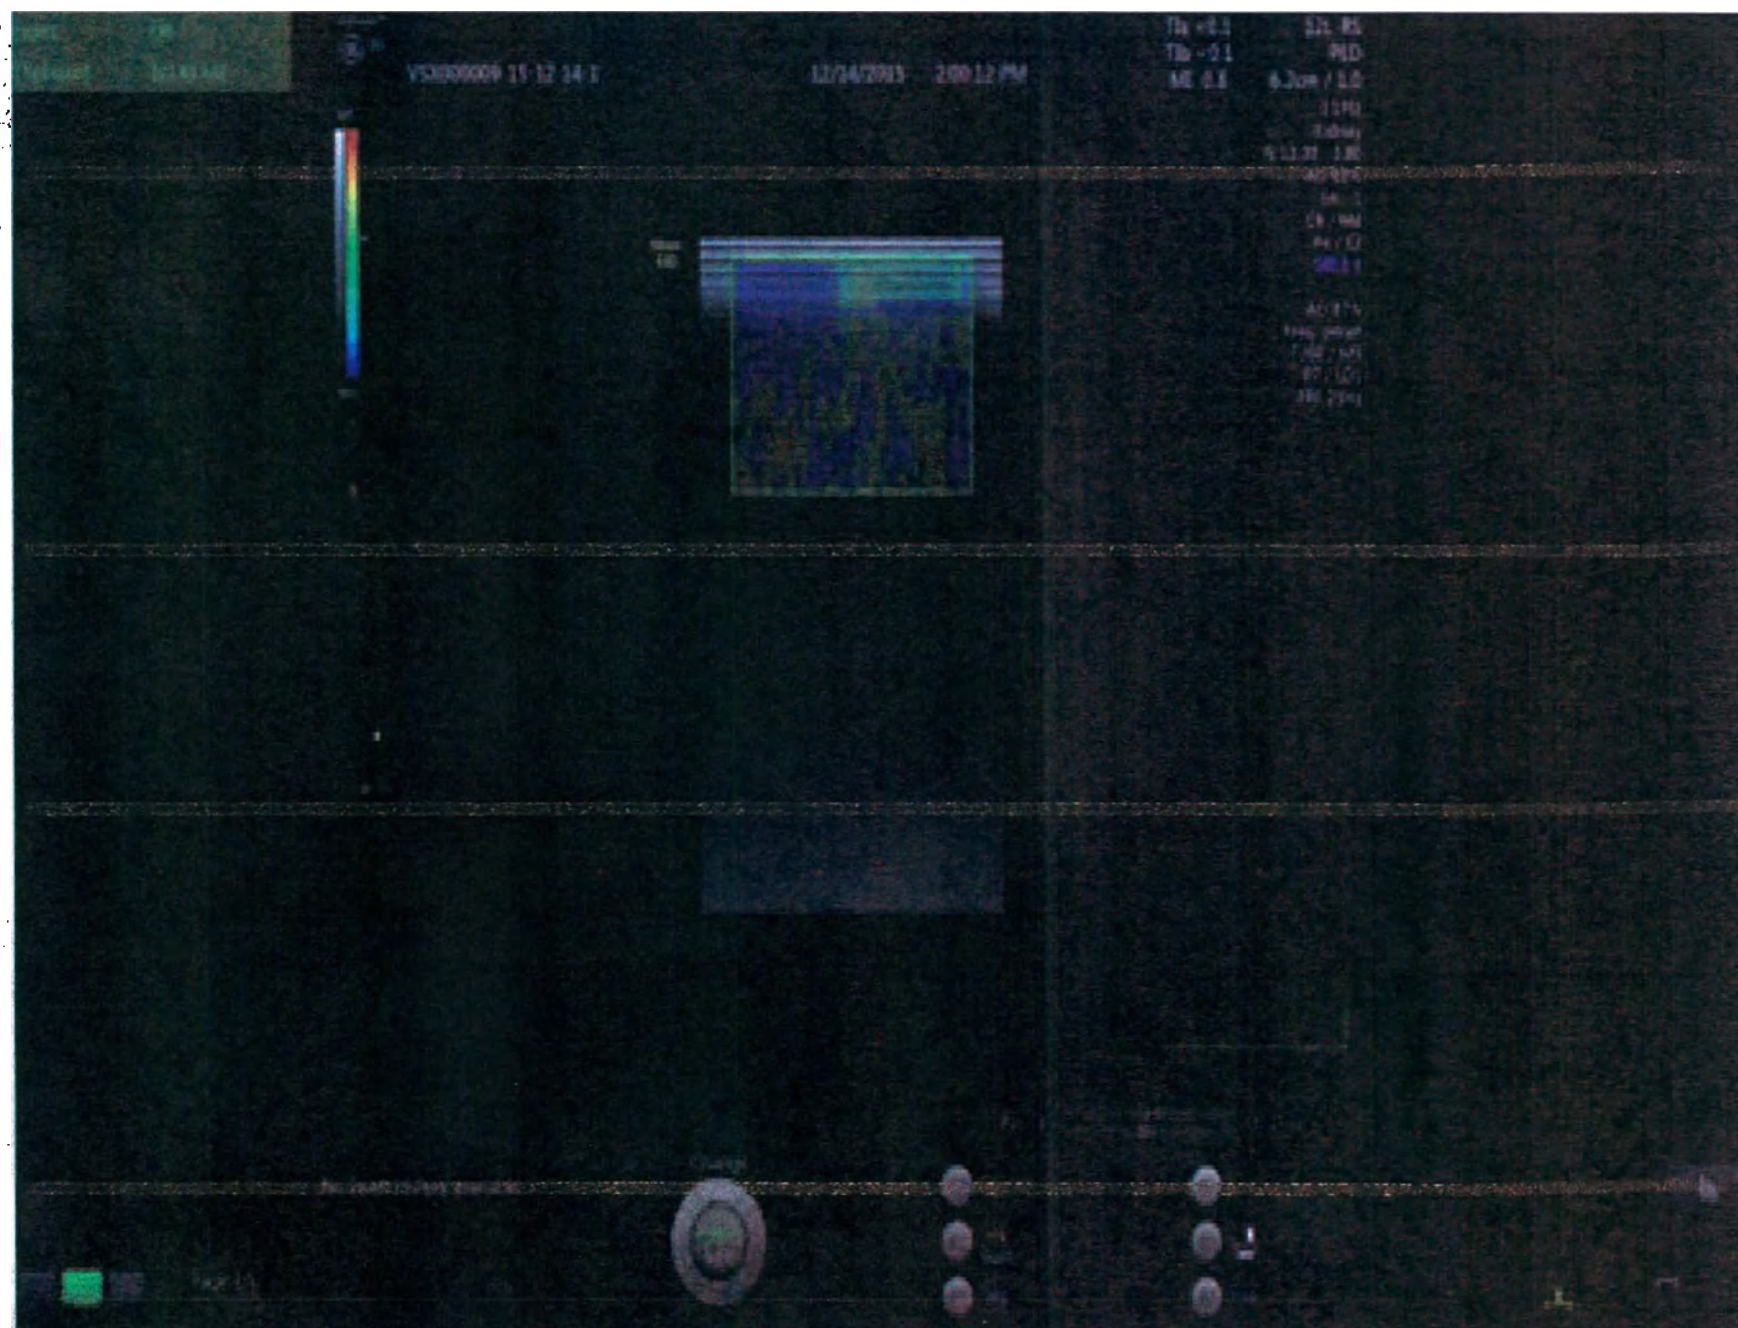

Модуль встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме эластографии, активируемый электронным ключом на (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




Модуль встроенный для определения плотности ткани, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

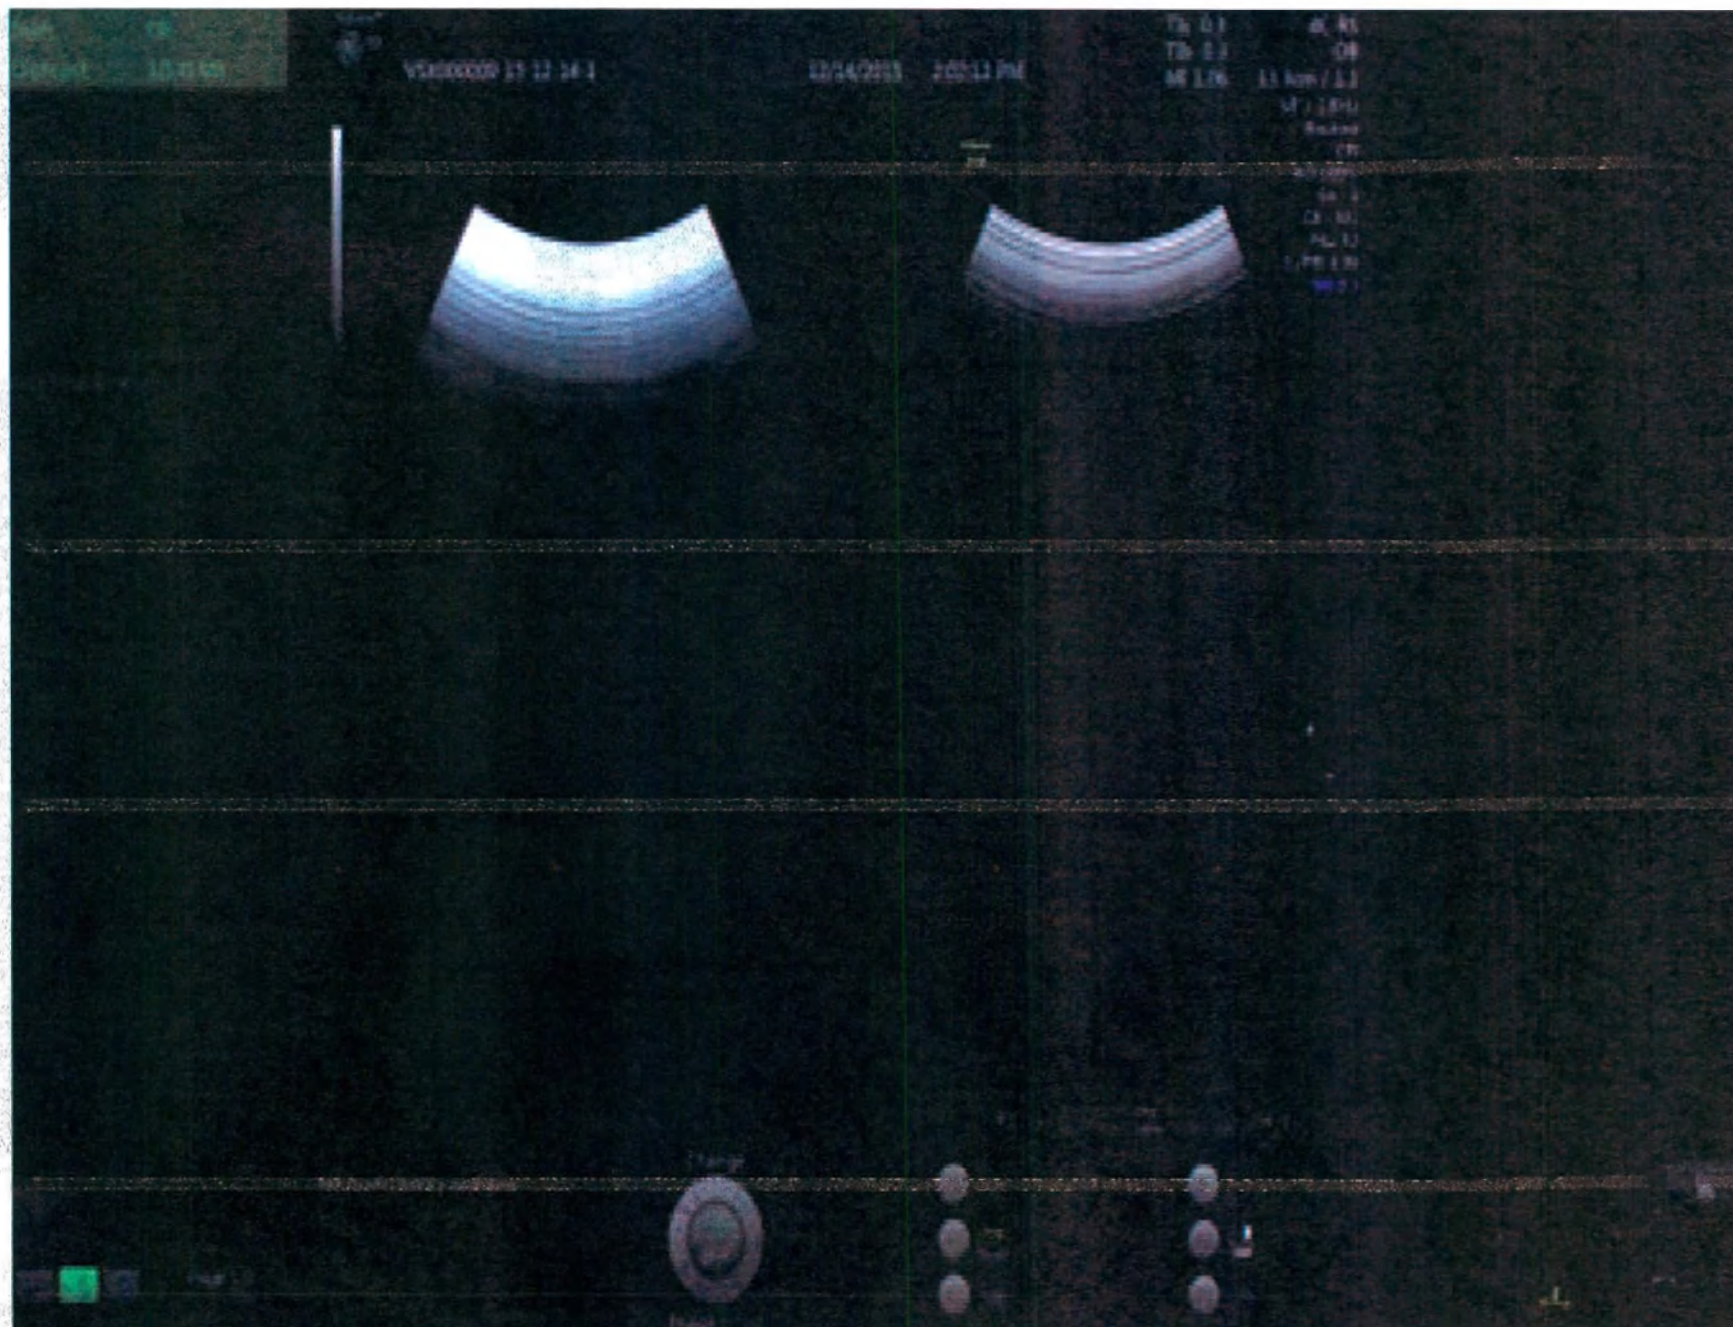

Модуль встроенный, обеспечивающий возможность работы с контрастными веществами, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ




Модуль встроенный для расчета объема анатомических структур VOCAL, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

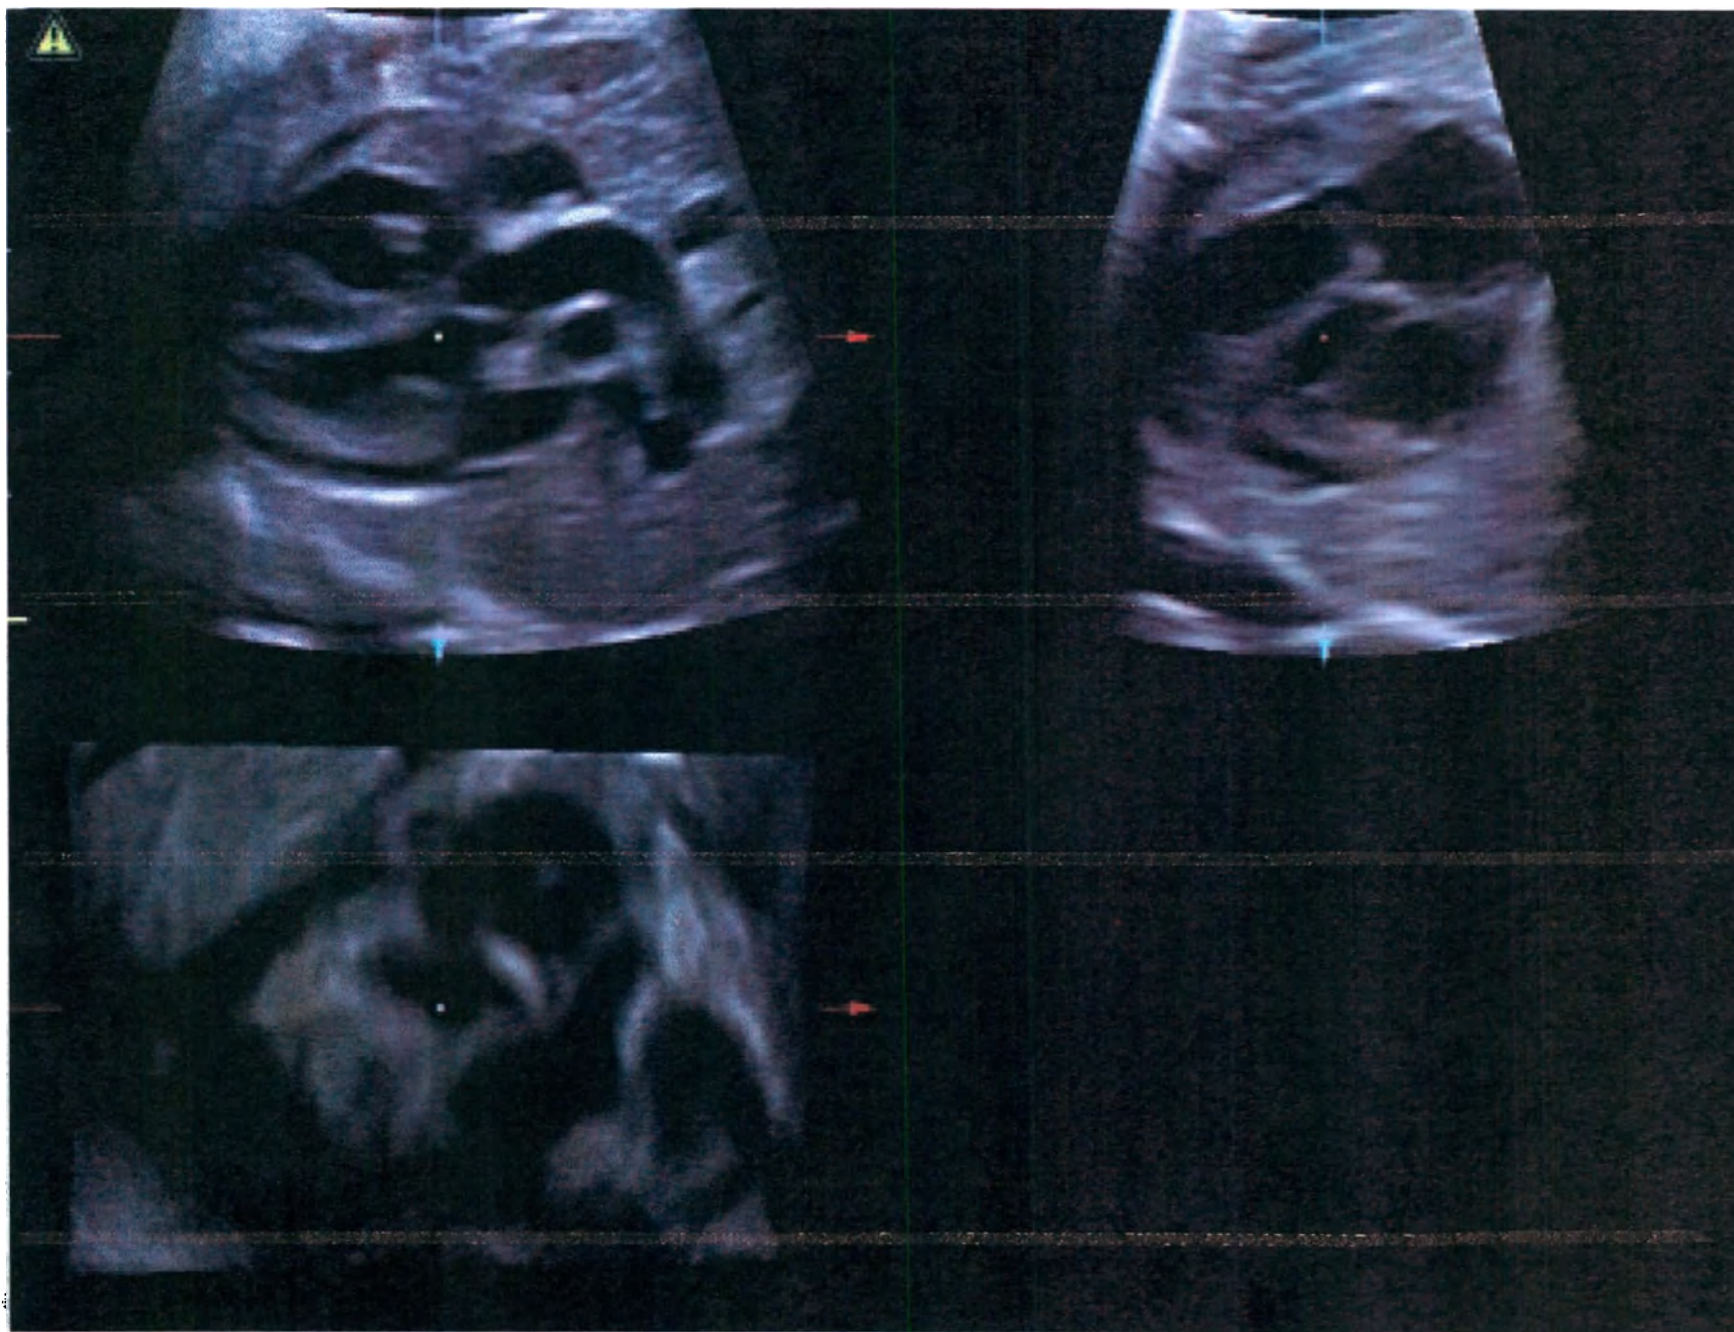

Модуль встроенный для регистрации работы сердца плода в режиме пространственно-временной корреляции изображений, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




Модуль встроенный для регистрации работы сердца плода в режиме объемной эхографии с определением плоскостей сканирования, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

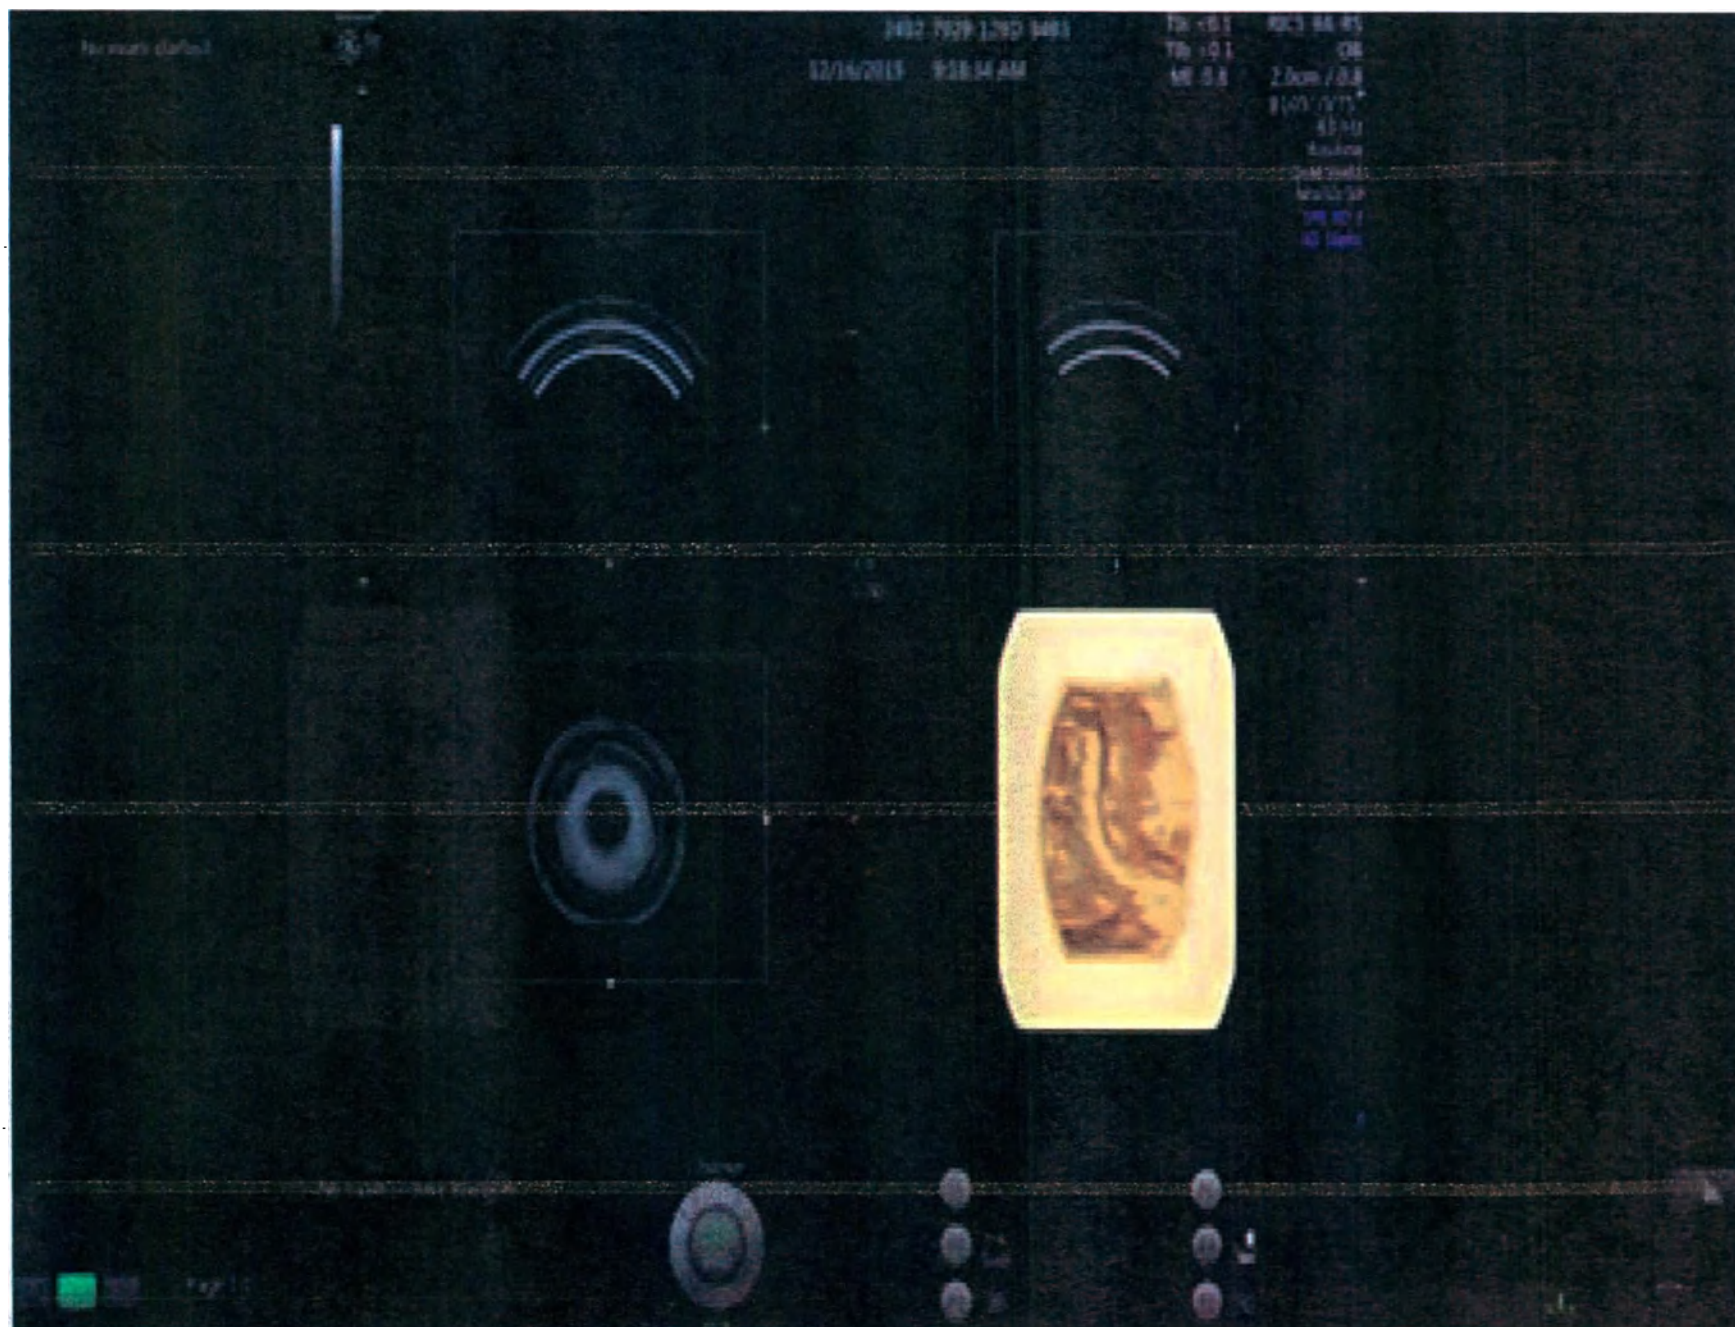


Модуль встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме инверсии, активируемый электронным ключом на

щитке (или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

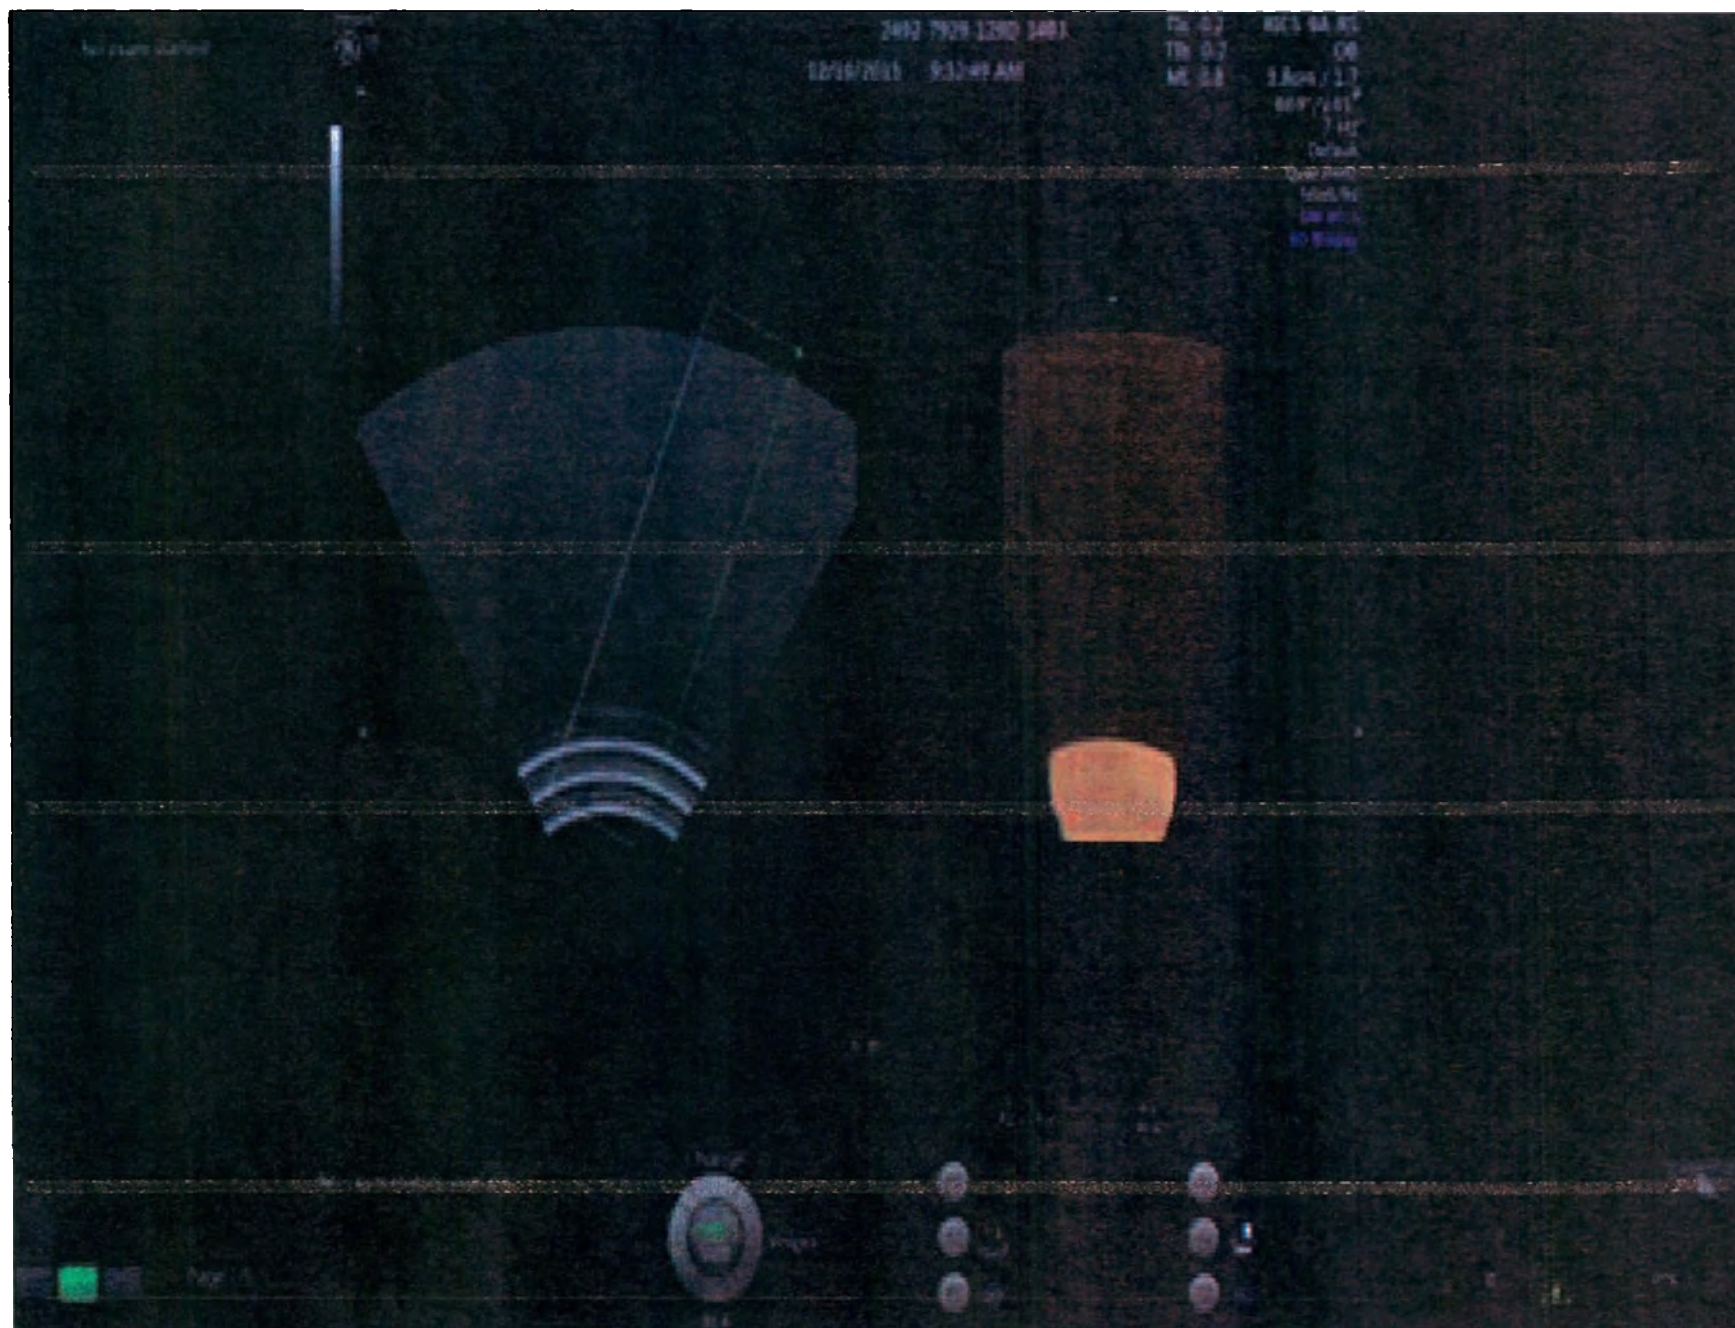

Модуль встроенный для обеспечения биопсии в режиме объемной эхографии, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или

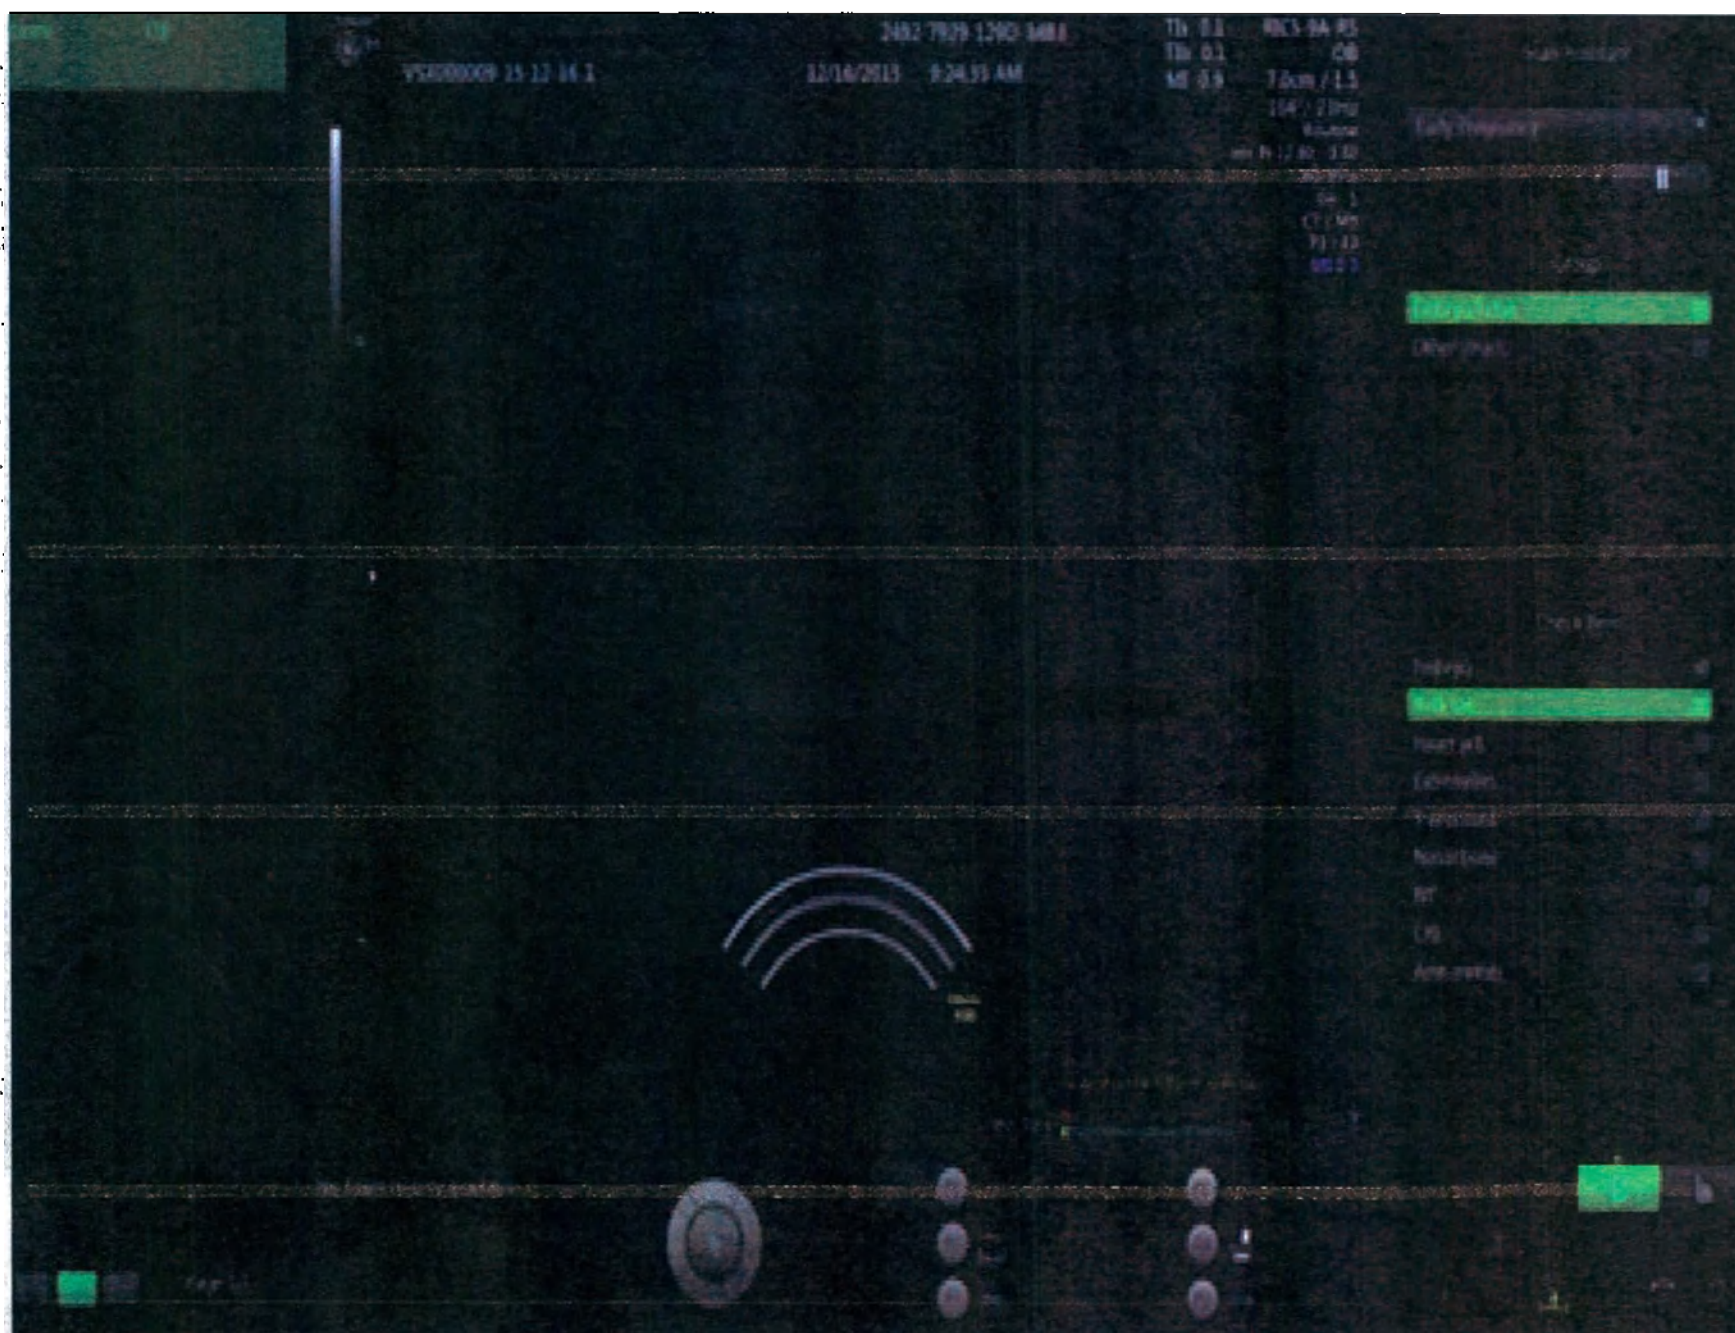

Модуль встроенный для протоколирования этапов ультразвукового исследования, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или

000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU (сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



Модуль встроенный для оптимизации изображения, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



Модуль встроенный, обеспечивающий запись на DVD и USB-устройства, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

27.03.2015 16:33:05 MI 0.7 7.0cm / 1.5

Детали

Аннотации

Буфер обмена

Отображение информ...

Помощь сканирован...

Дата и время

Дата: Friday, 27-March-2015

Время: 16:33:05 (hh:mm:ss)

Изменить дату и время

Формат даты

• ГГГГ/ММ/ДД

• ММ/ДД/ГГГГ

• ДД.ММ.ГГГГ

Формат времени

• 24 часа (14:25:49)

• tt 12 часов (PM 2:25:49)

• 12 часов tt (2:25:49 PM)

Название клиники

Отображение

☐ Показать кривую КУТ

☐ Активировать вход в систему

☒ Заставка

Актив. блокир. сист. с згр. заставкой

Язык

Система Russian

ЭРП Russian

Прочее

☒ ОстанАвтоскан

☐ Экран.злем.управл. 3D/4D

☐ Звук Выкл

☐ MI > 1,0 отображ.оранж.

☐ Сенсорная панель: отключ. пров


Режим презентации

Сохранить


Сохранить и вы...

Модуль встроенный, обеспечивающий поддержку русского языка, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

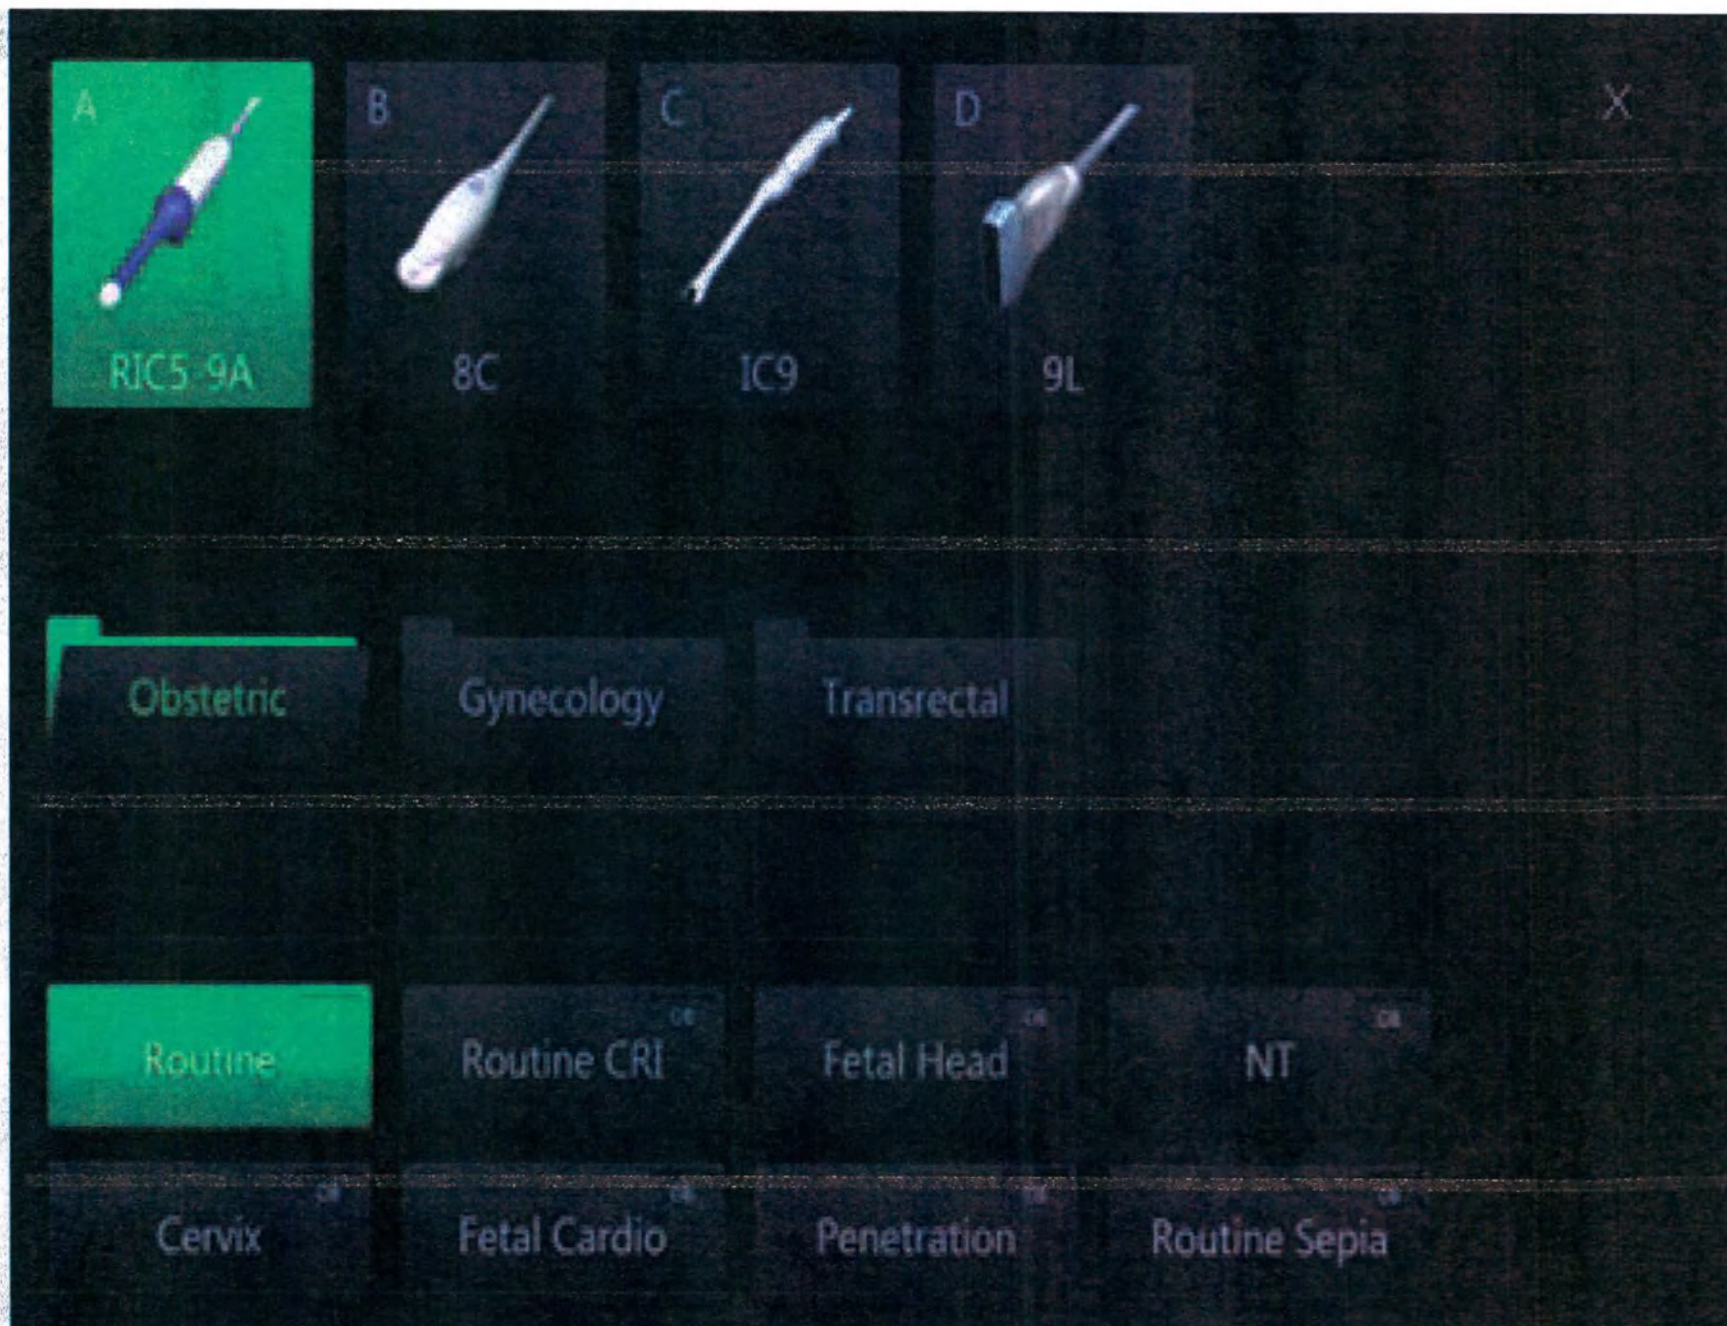

Модуль встроенный для обеспечения работы дополнительного порта датчика, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или

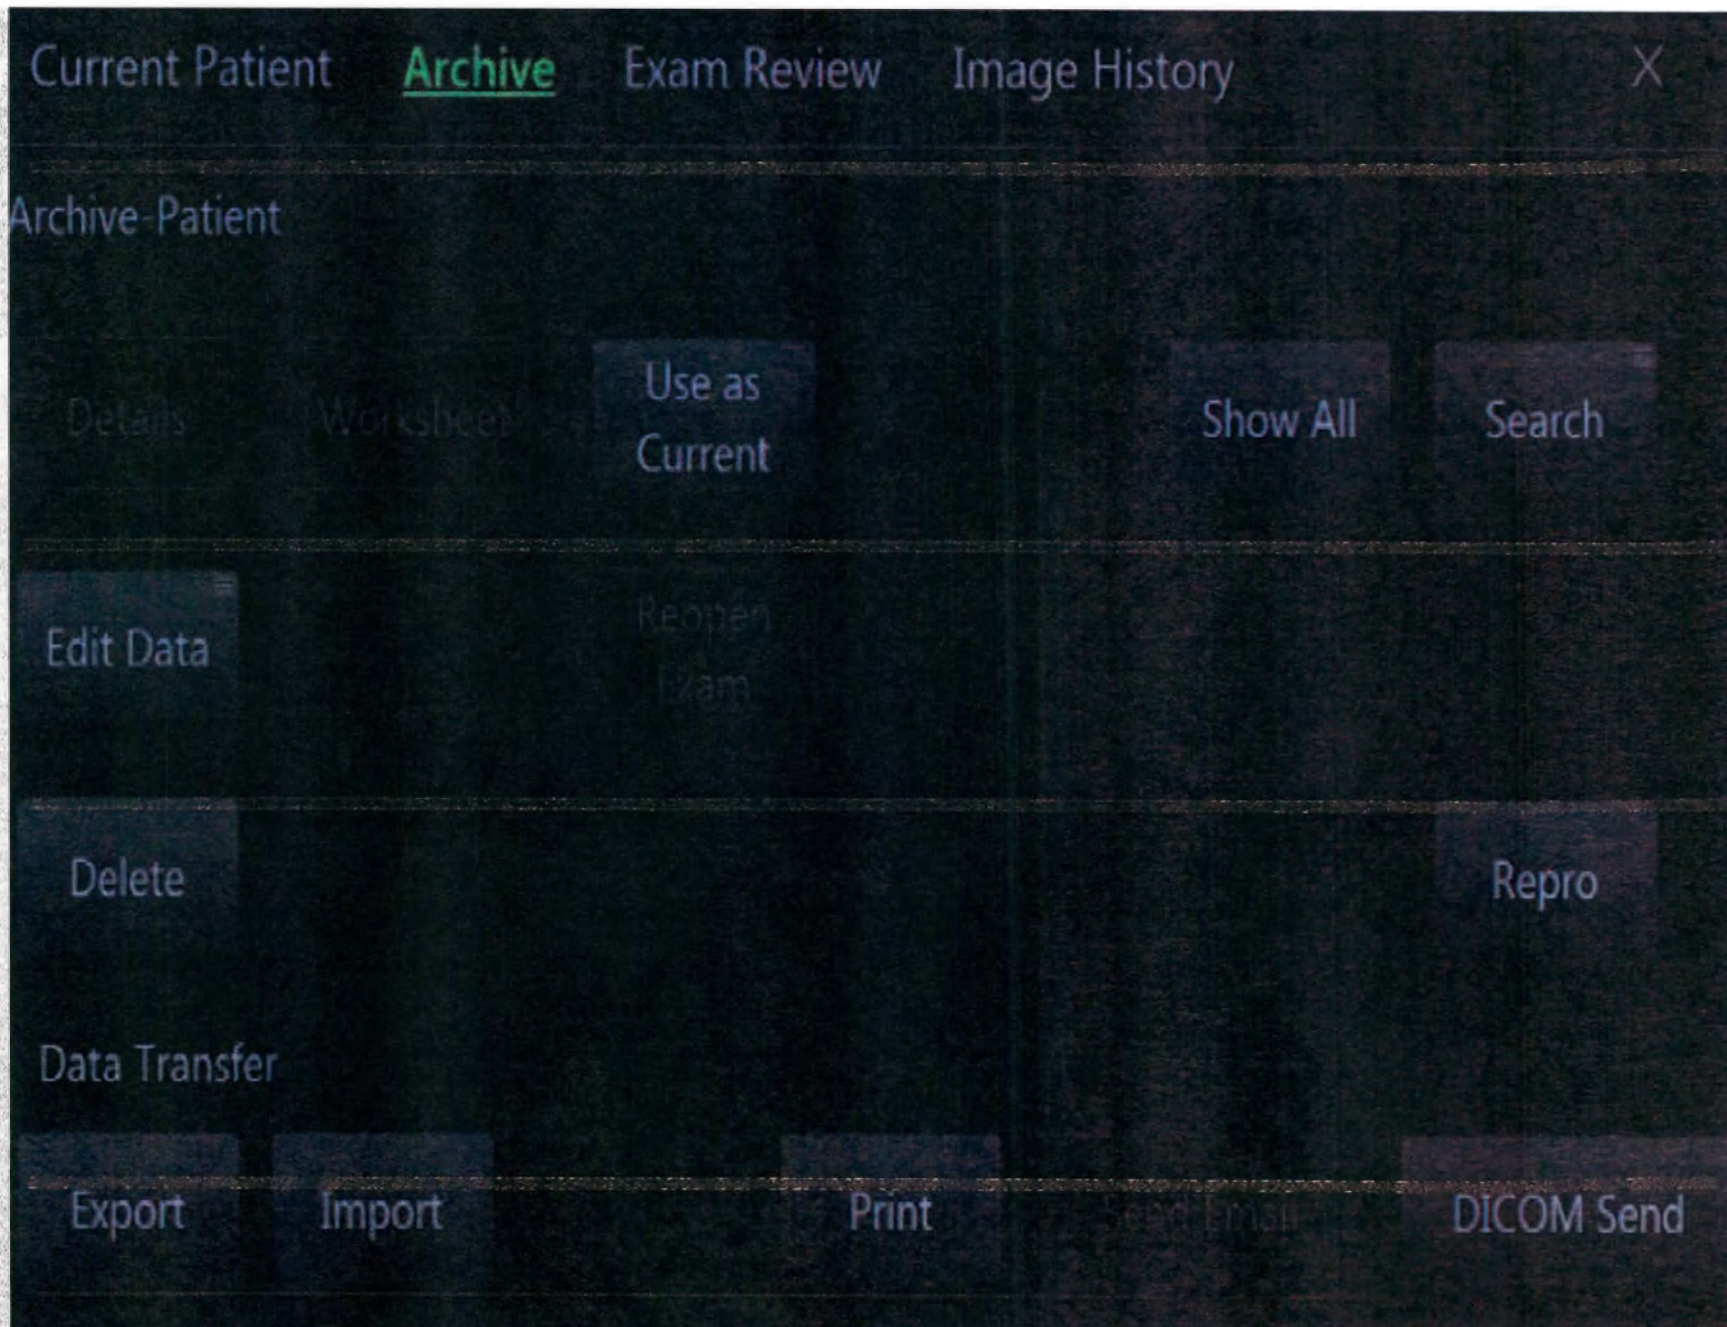


Модуль встроенный для работы с объемными изображениями, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




Модуль встроенный для улучшенной визуализации кровотока, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



Модуль встроенный для оптимизации изображения при исследовании эндометрия, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или

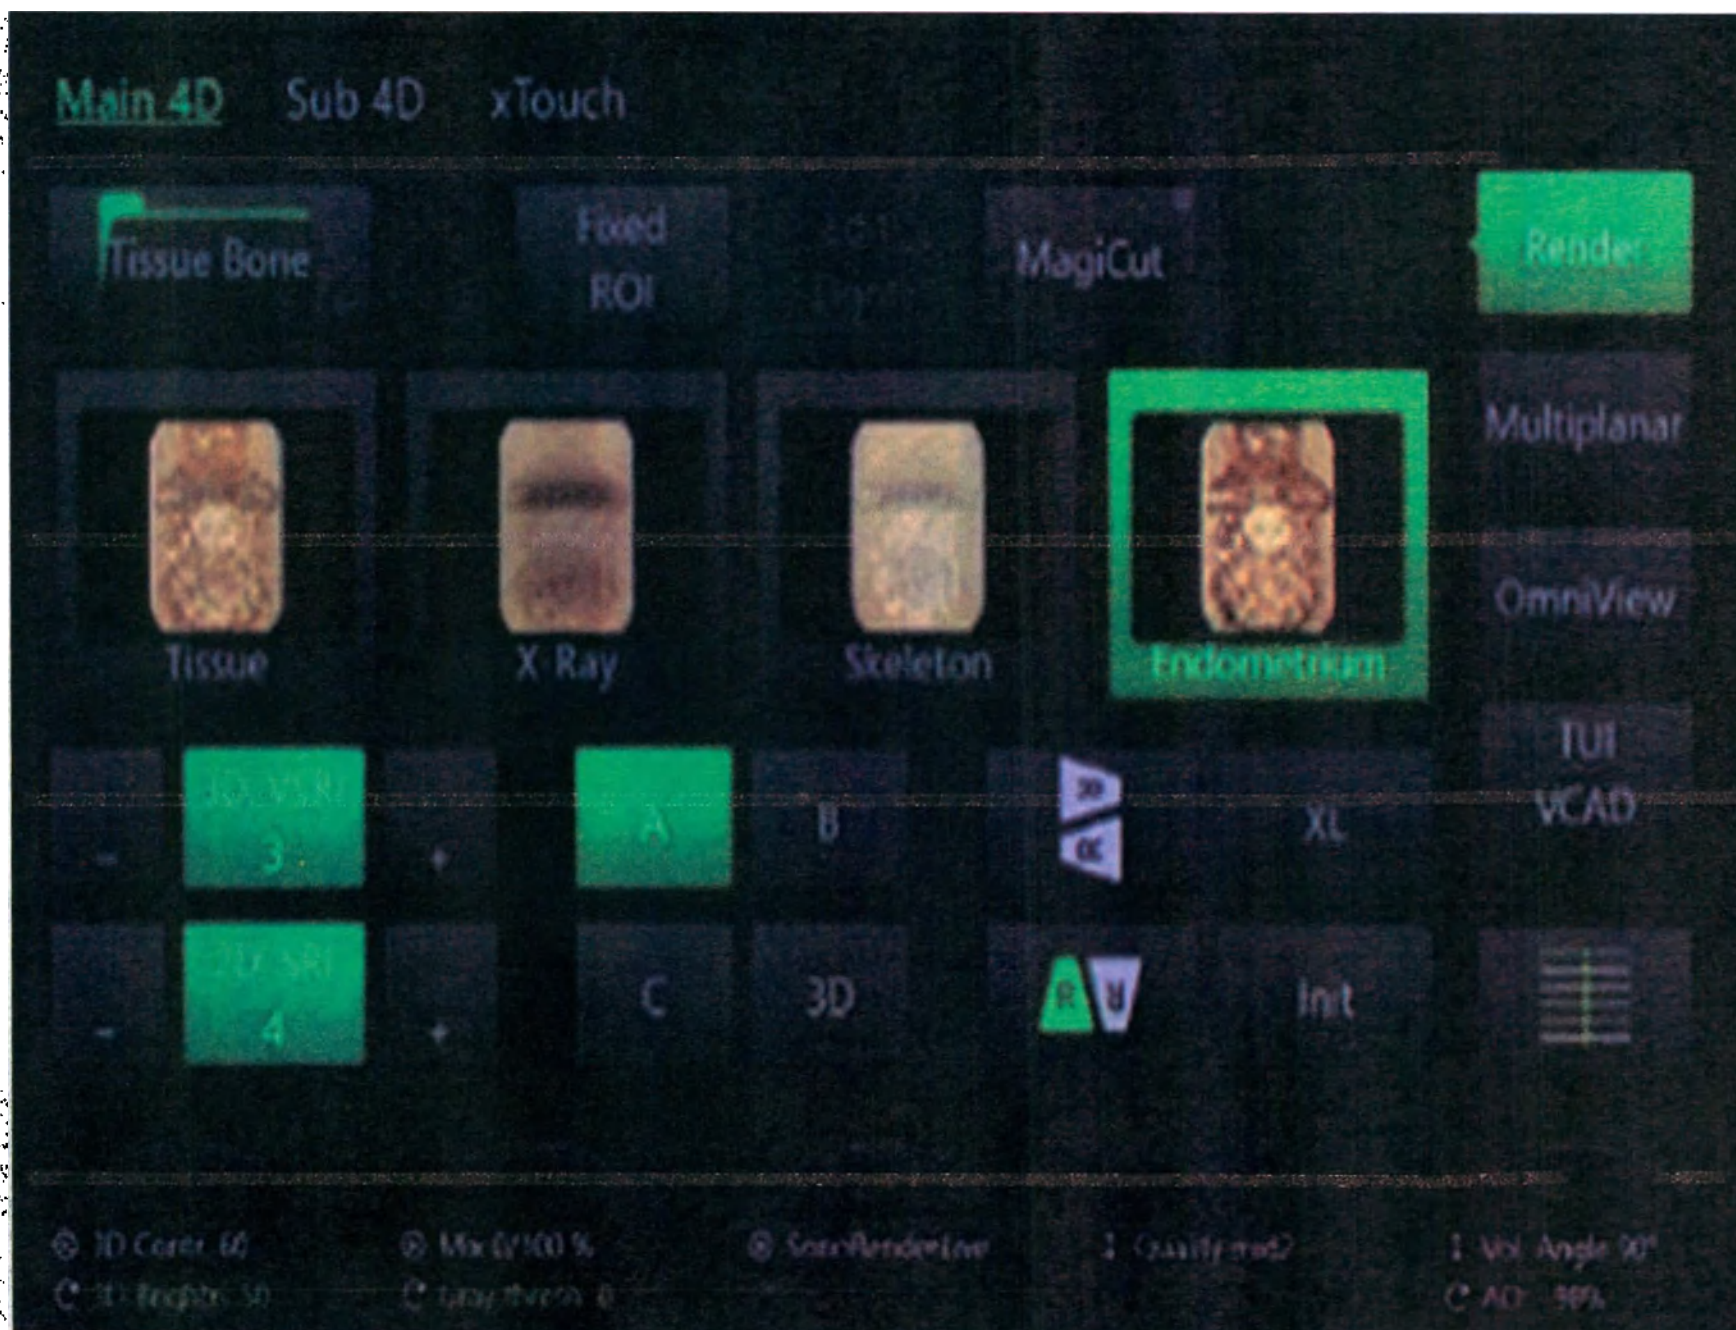

Модуль встроенный для оптимизации объемного изображения, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

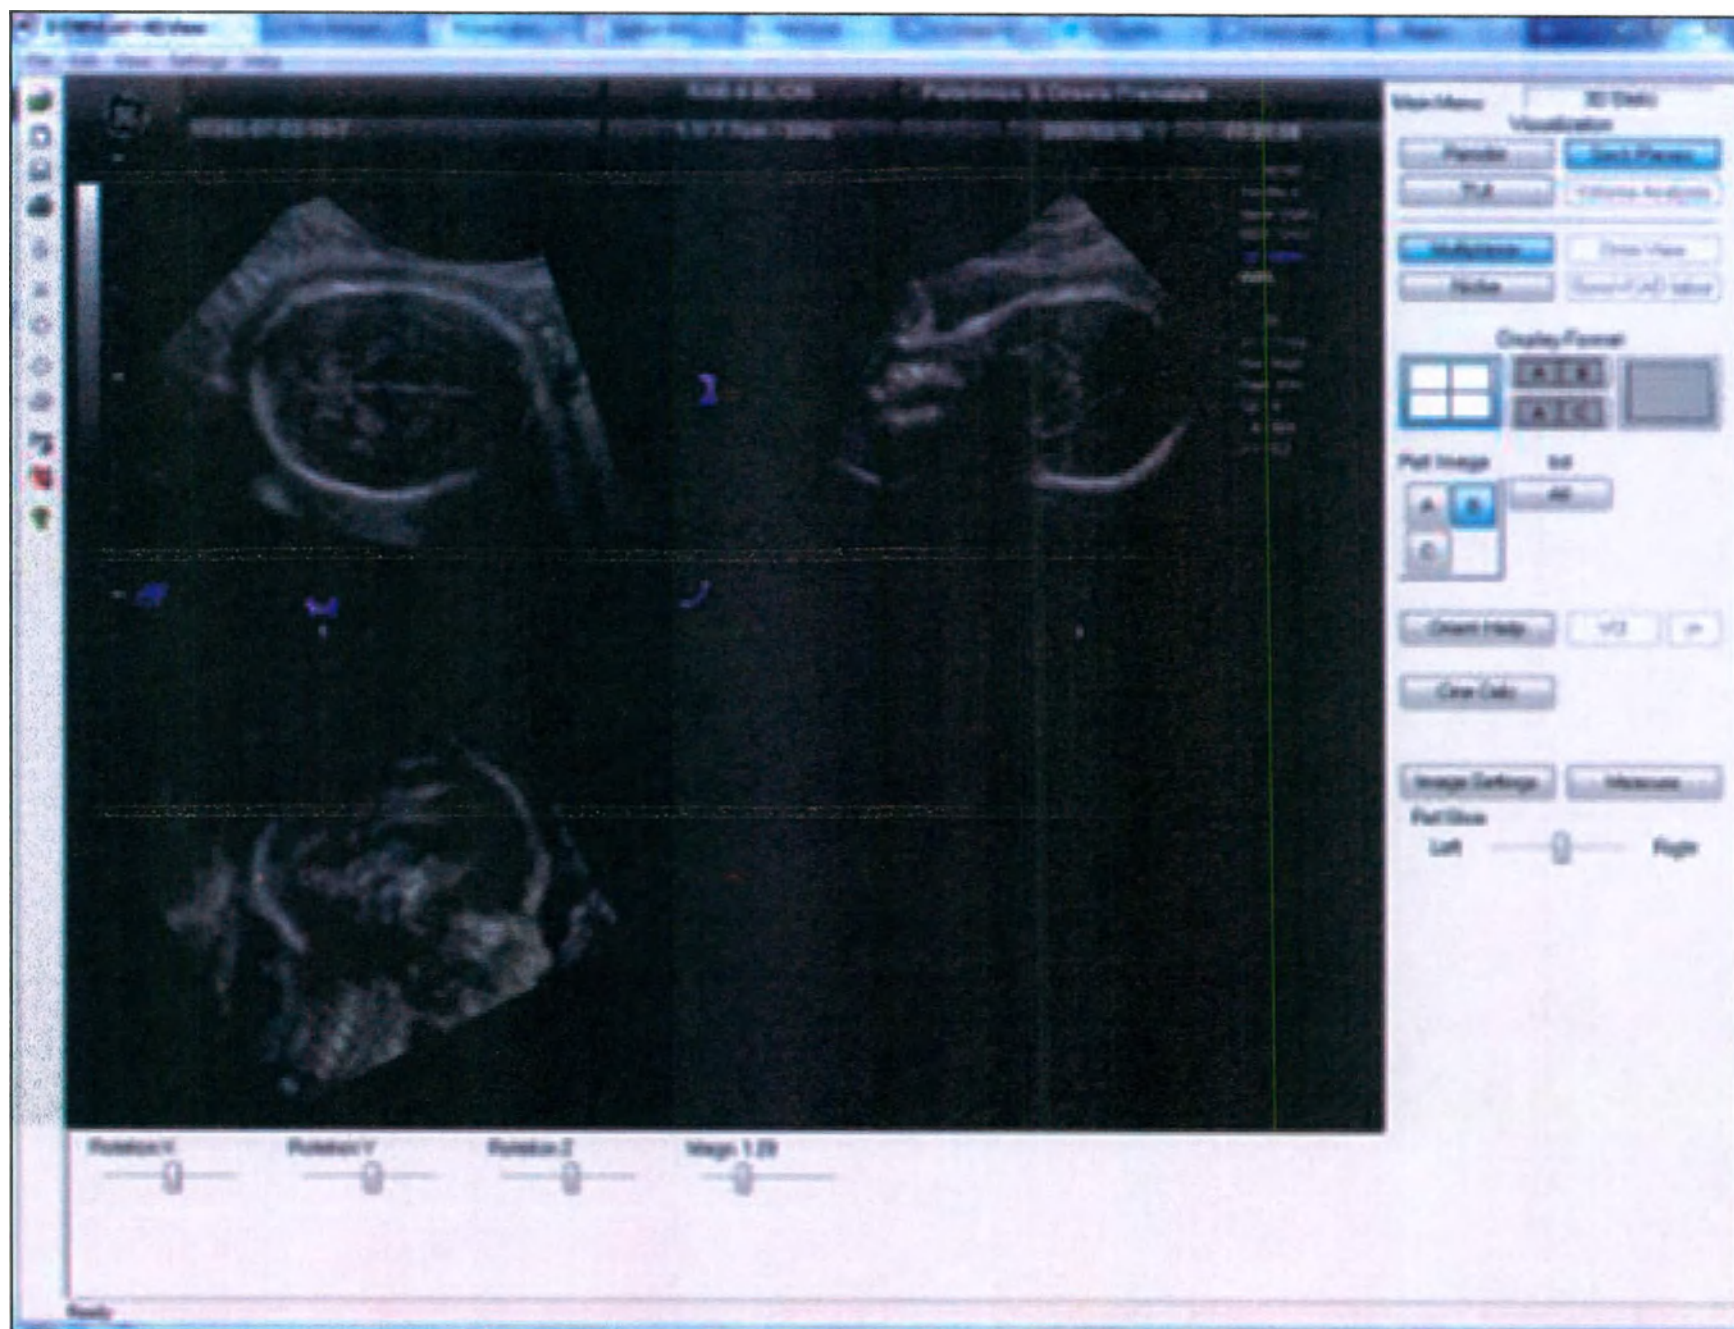

Программное обеспечение 4DView для хранения и обработки ультразвуковых изображений на электронном и/или оптическом и/или бумажном носителе

4DView


для версии программного обеспечения 18

Инструкции по эксплуатации


На русском языке (Russian)




Номер по каталогу: DOC2046828_ru-RU
Редакция 6
для версии программного обеспечения
© General Electric, 2021 г.

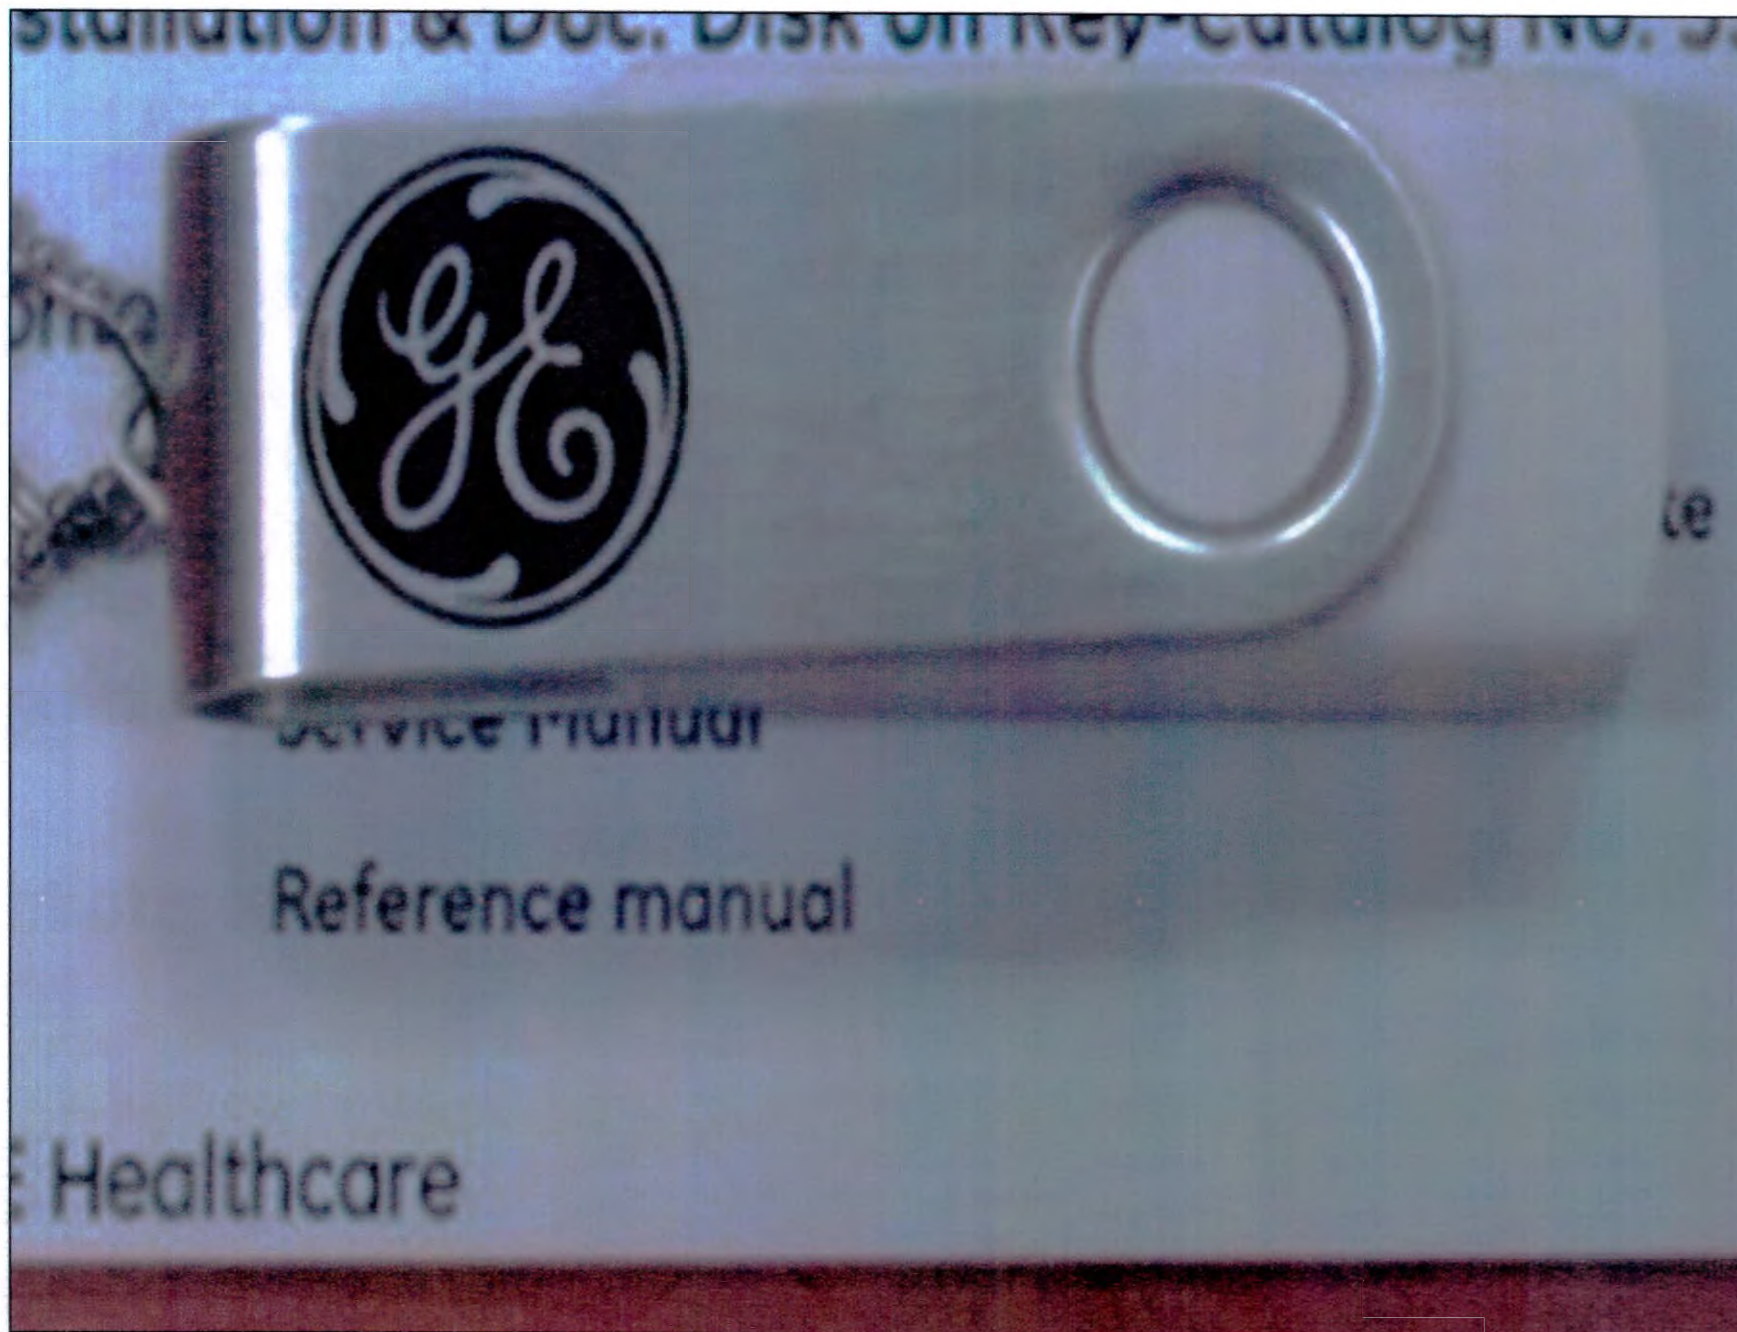


Руководства пользователя для 4D View на электронном и/или оптическом и/или бумажном носителе

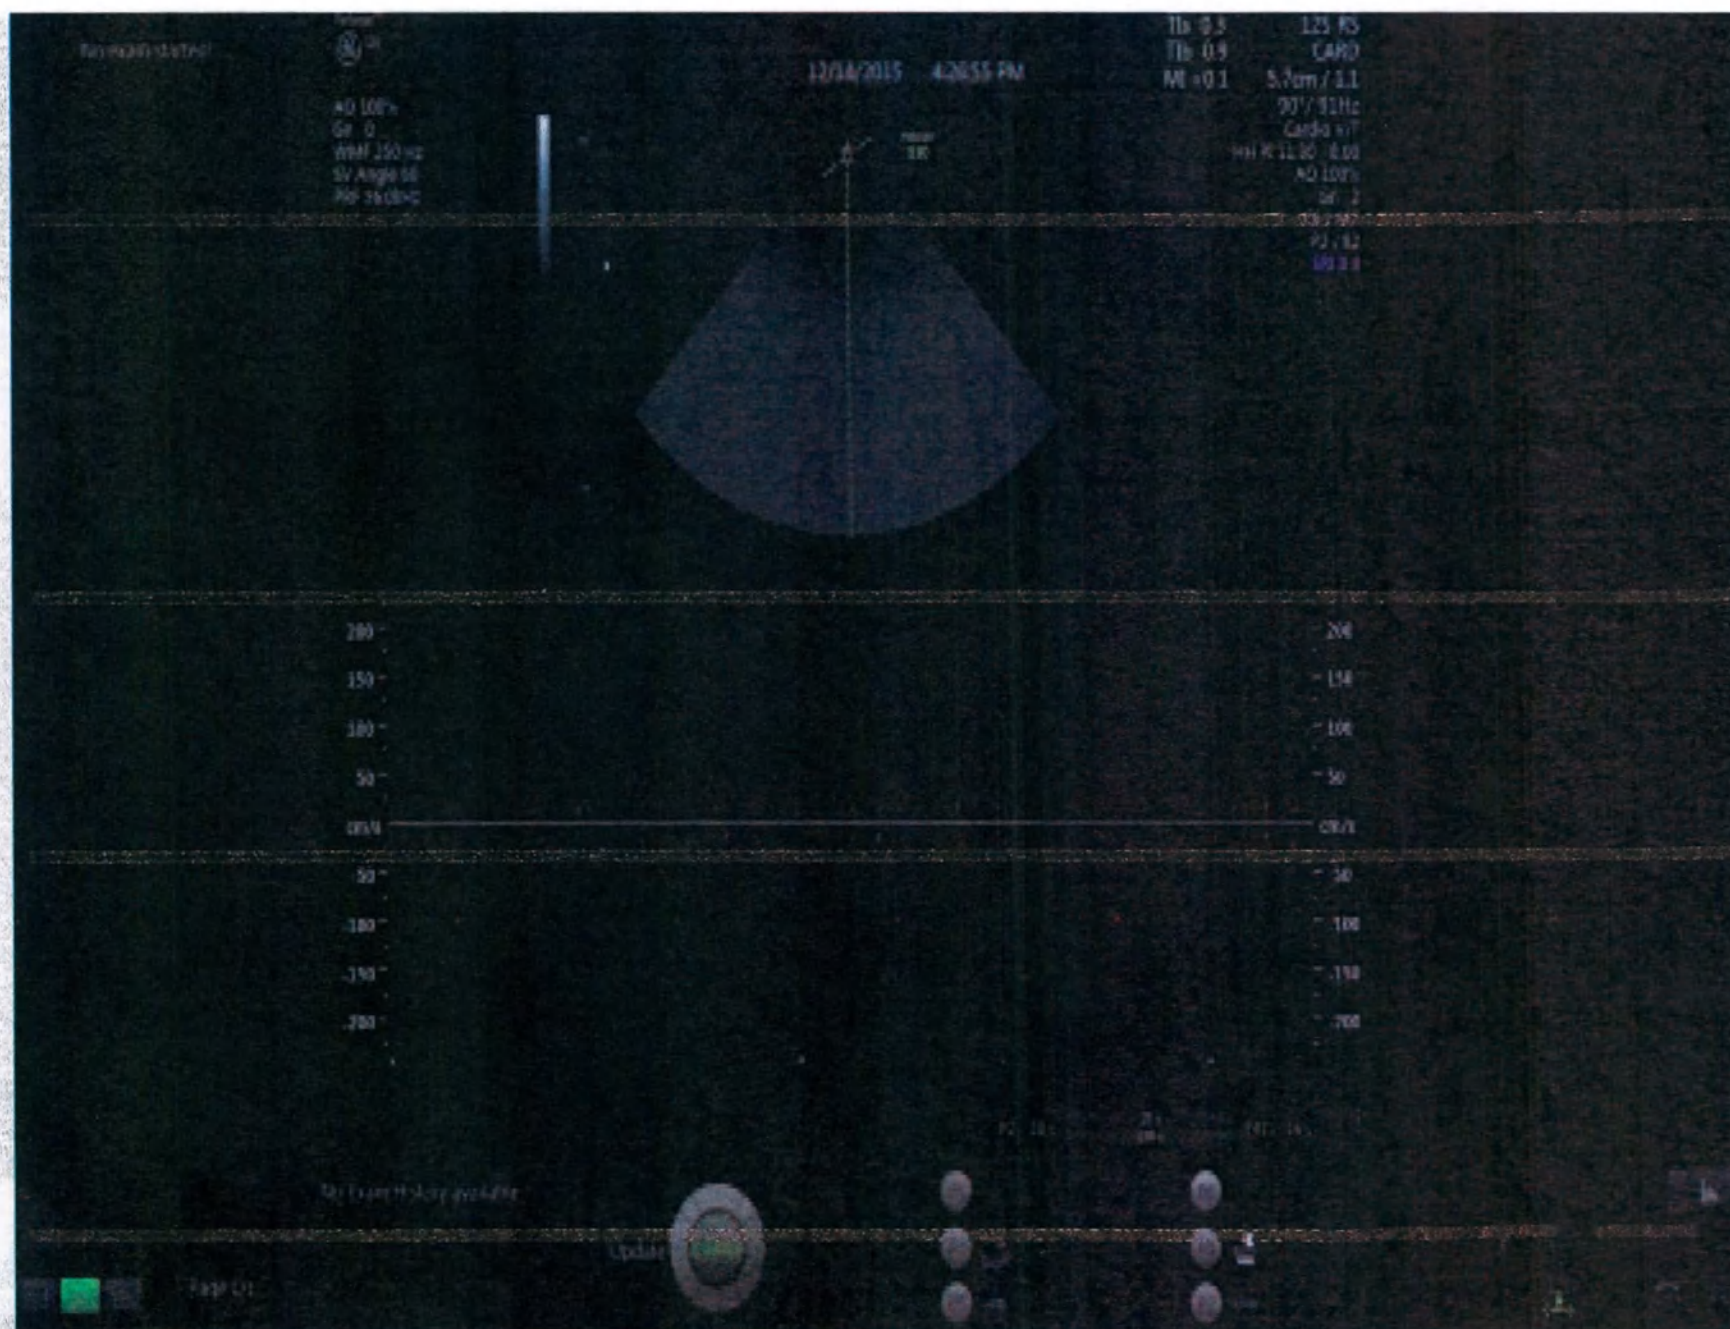


Модуль встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового доплера, активируемый электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

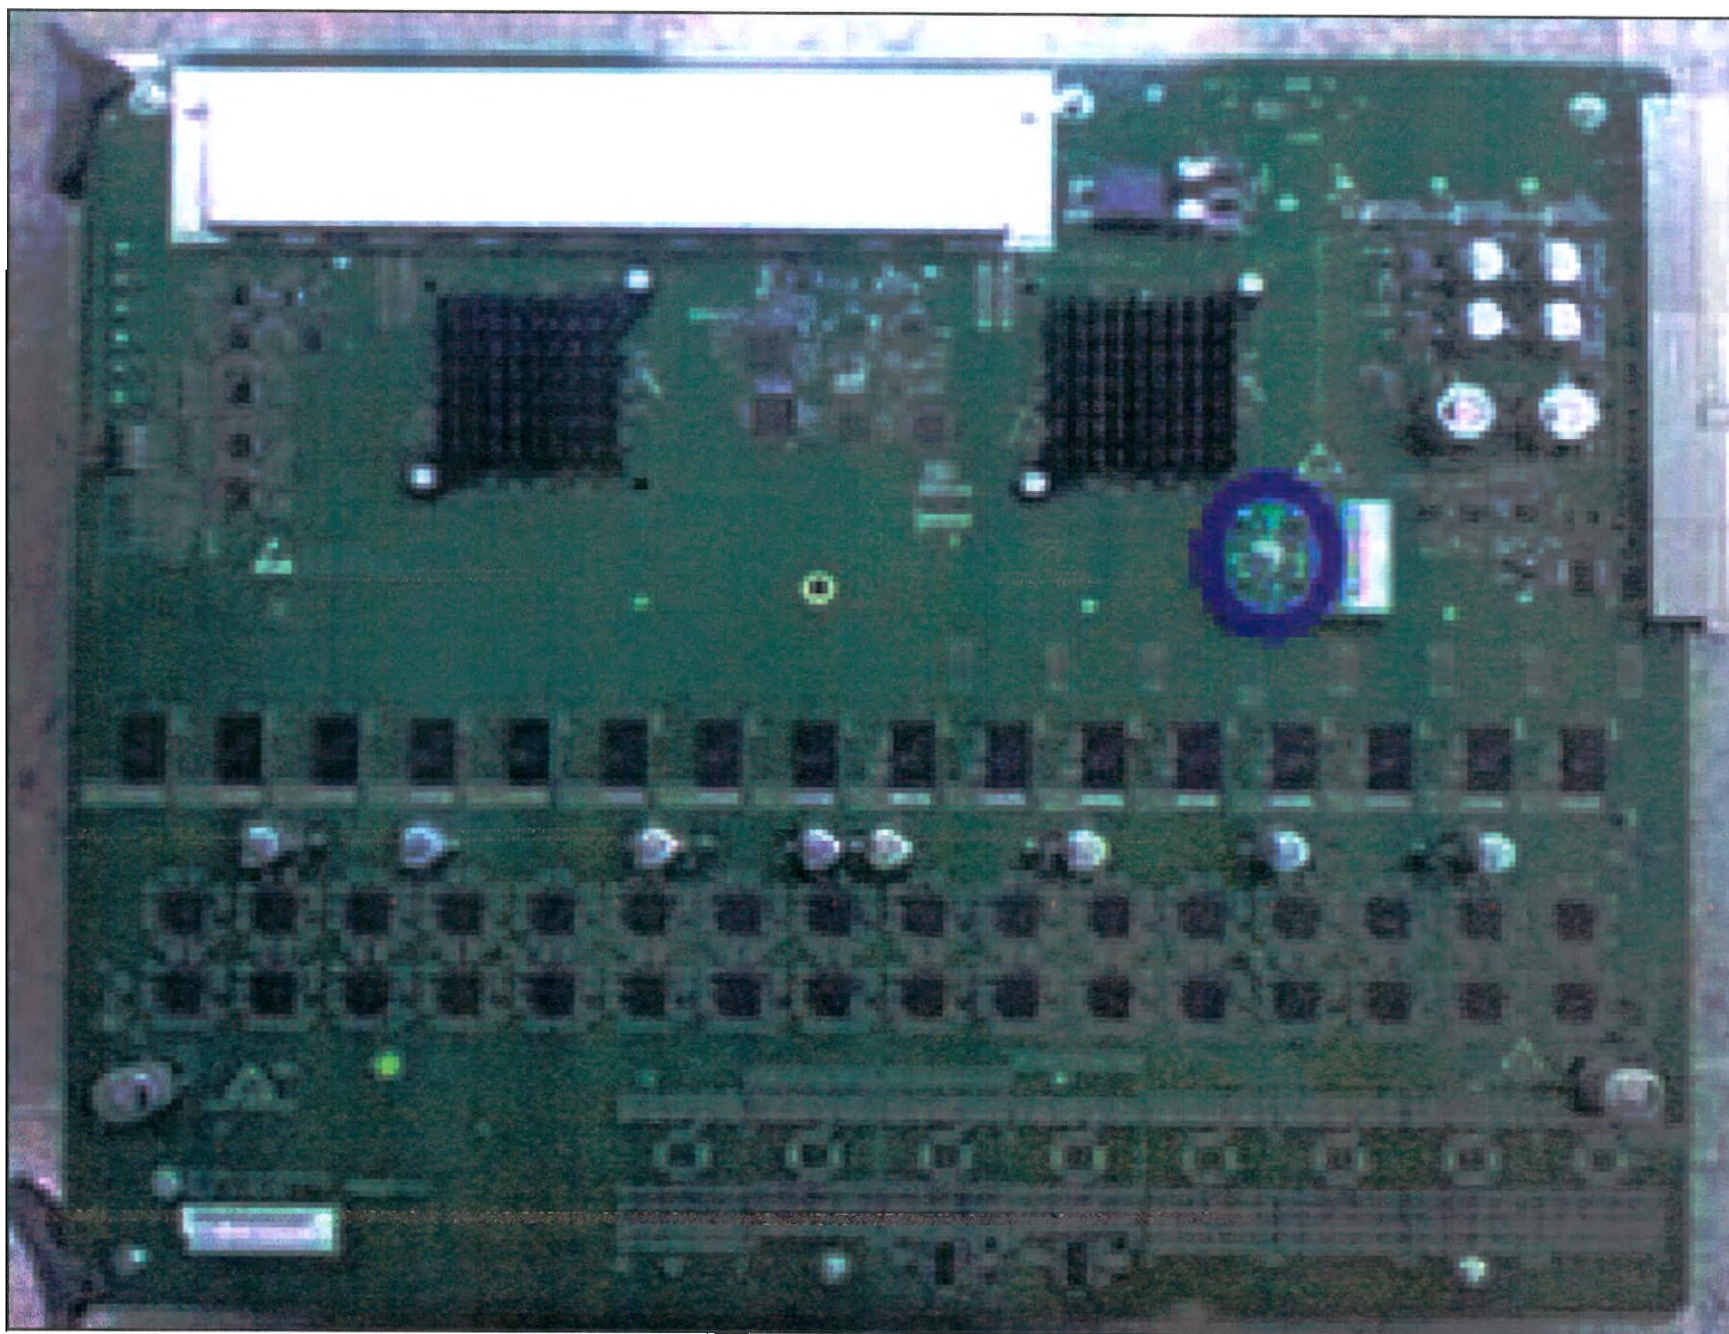


Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового доплера

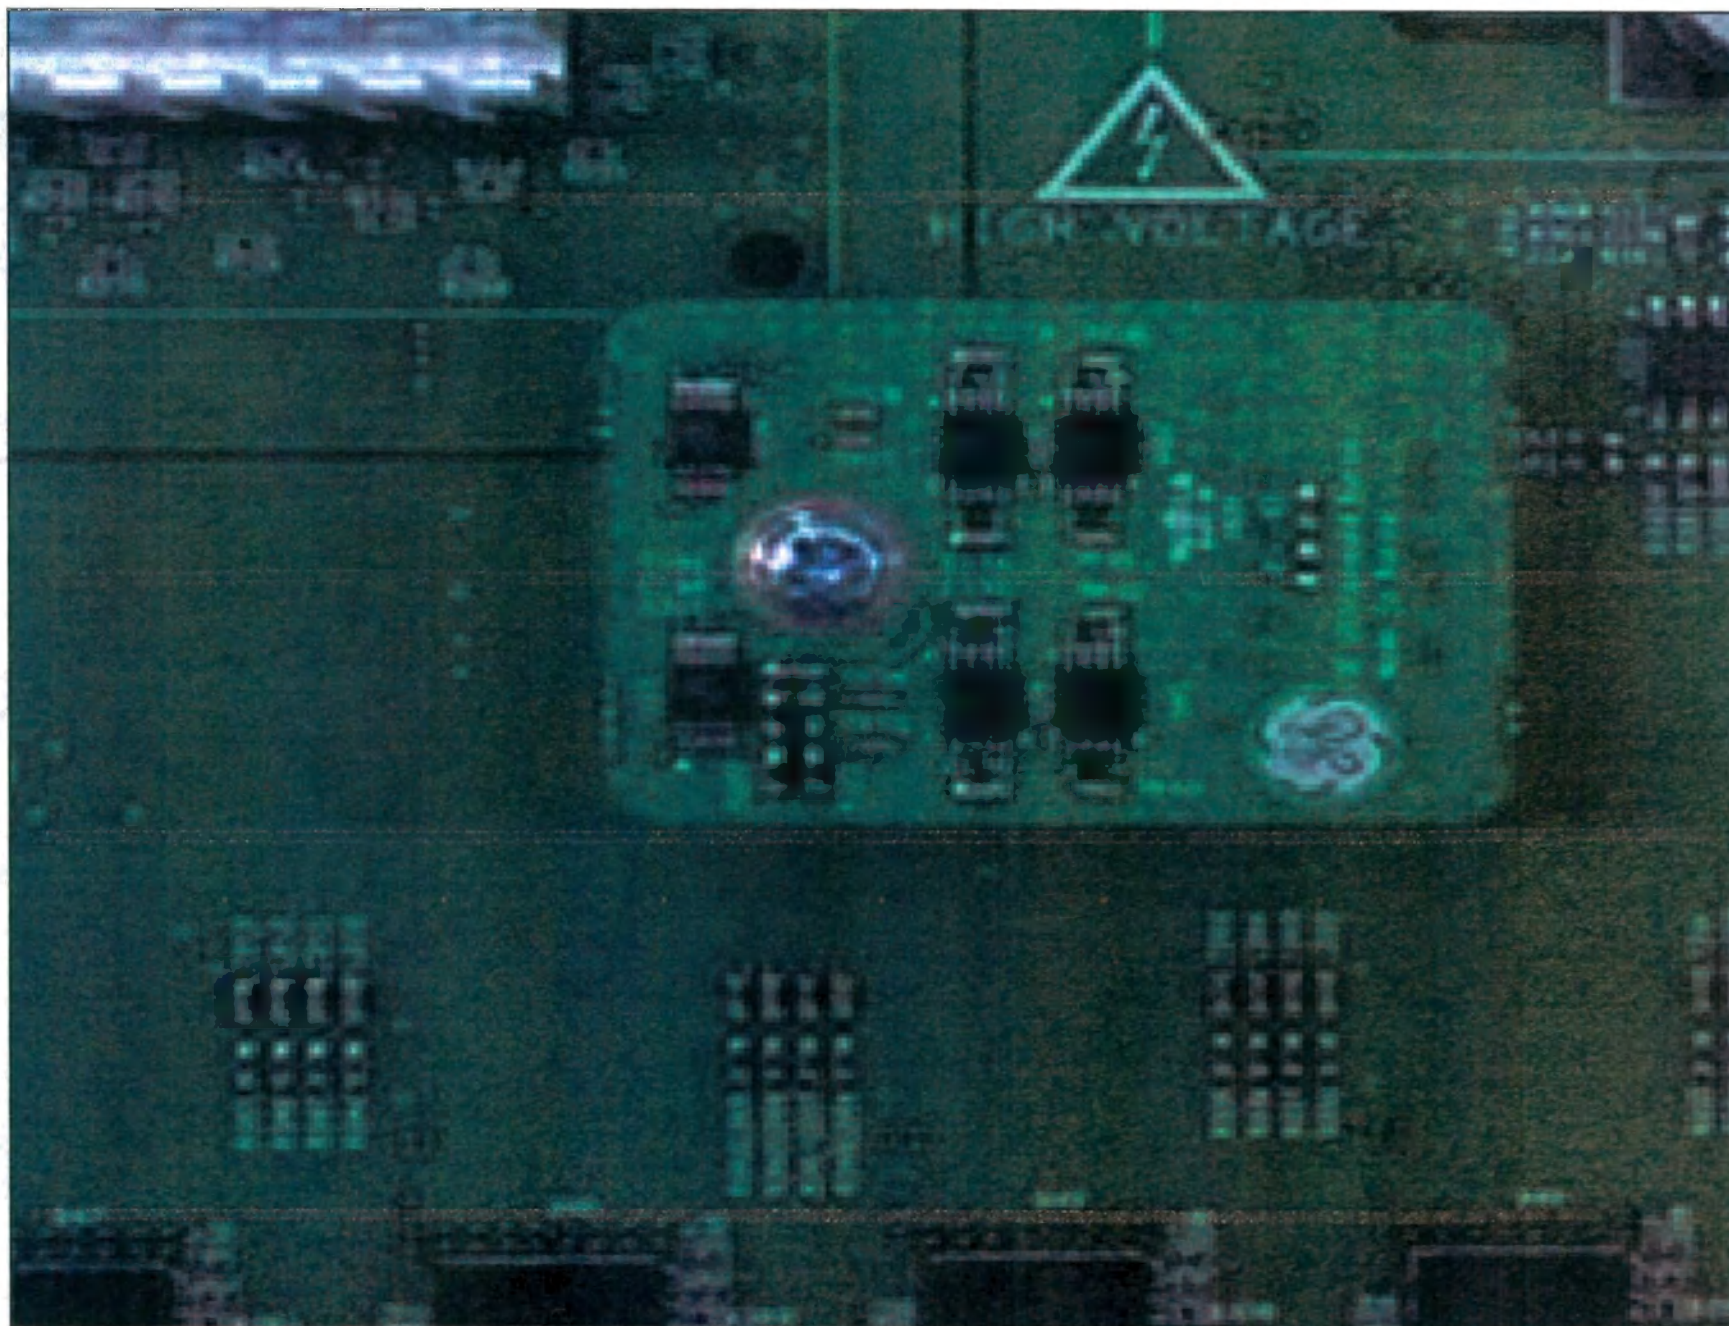


Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового доплера

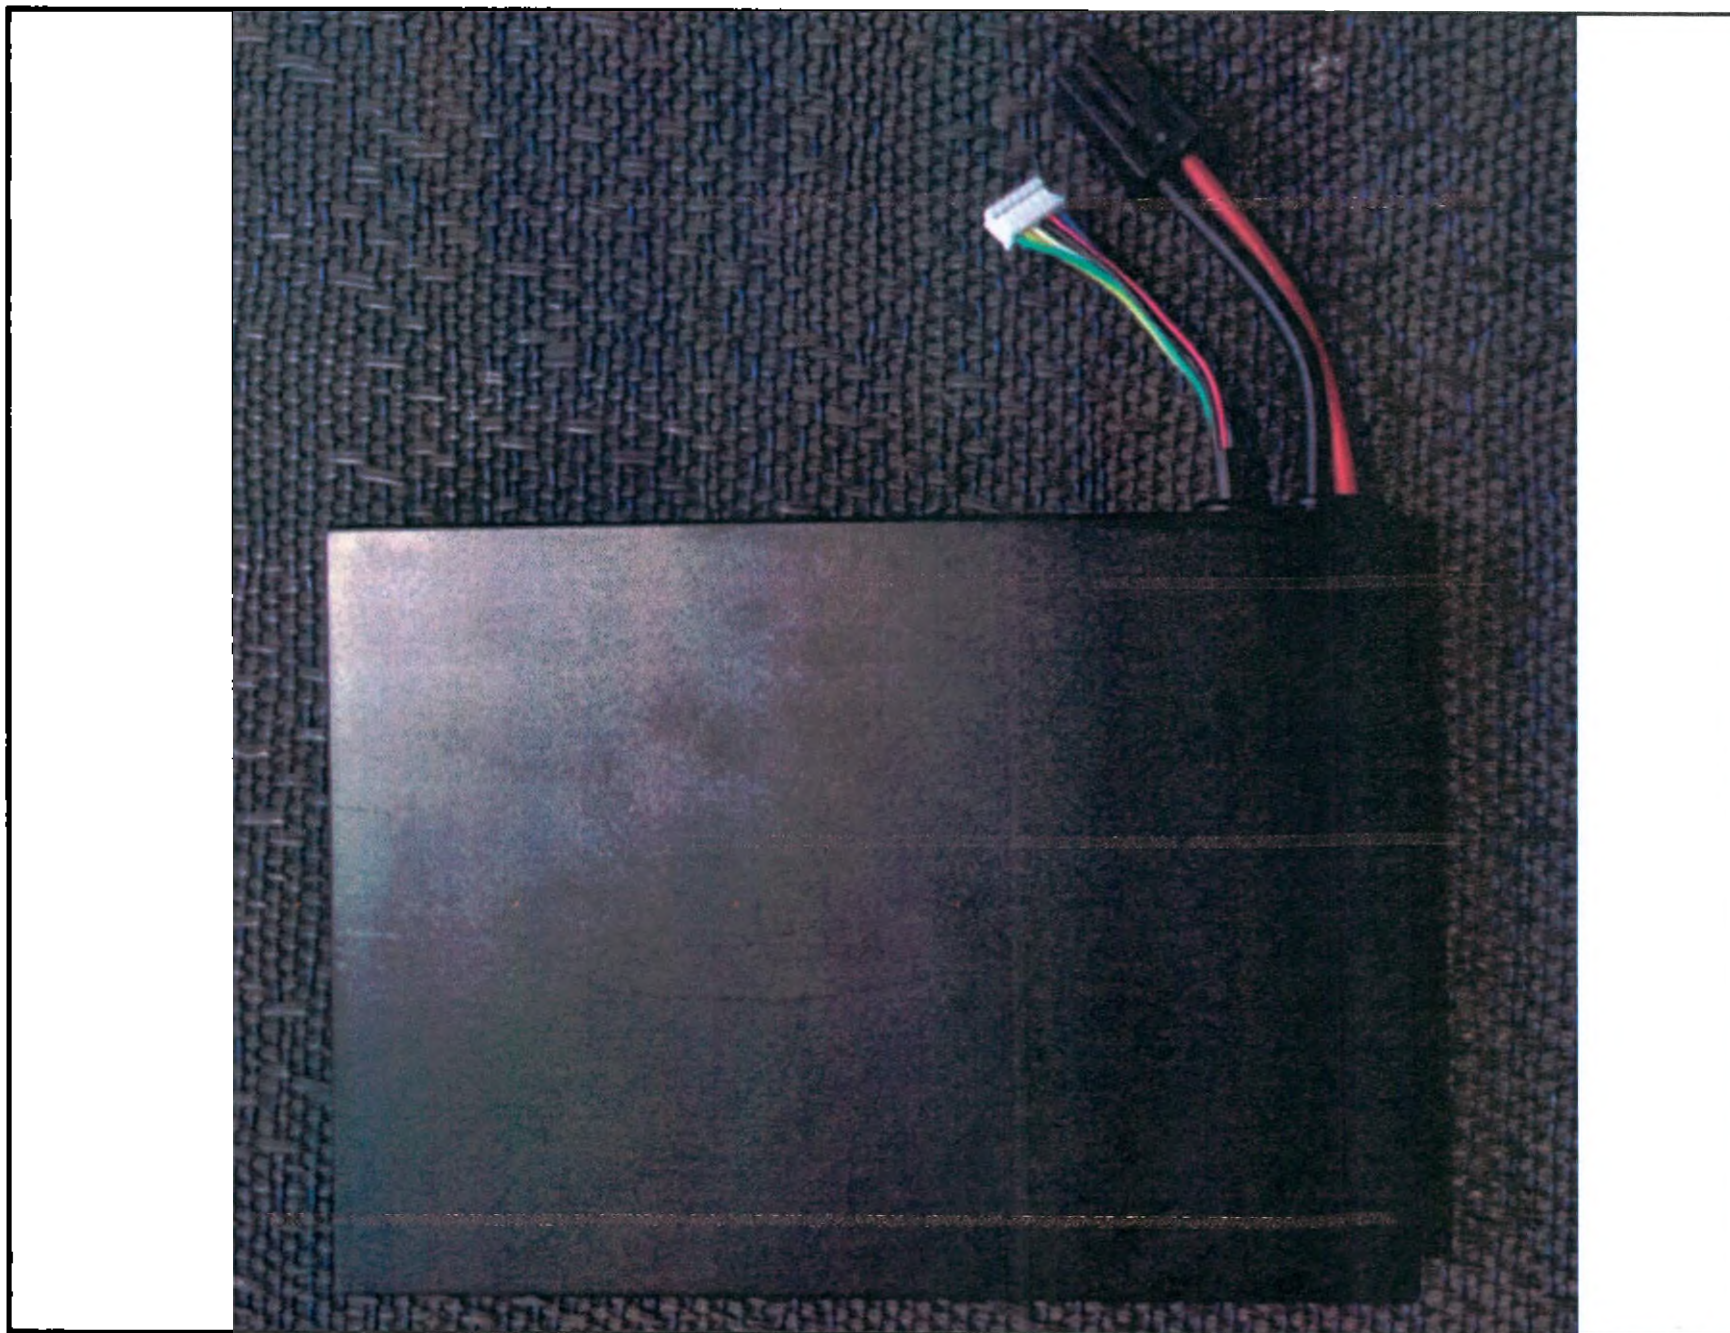


Встроенная батарея для обеспечения бесперебойной работы

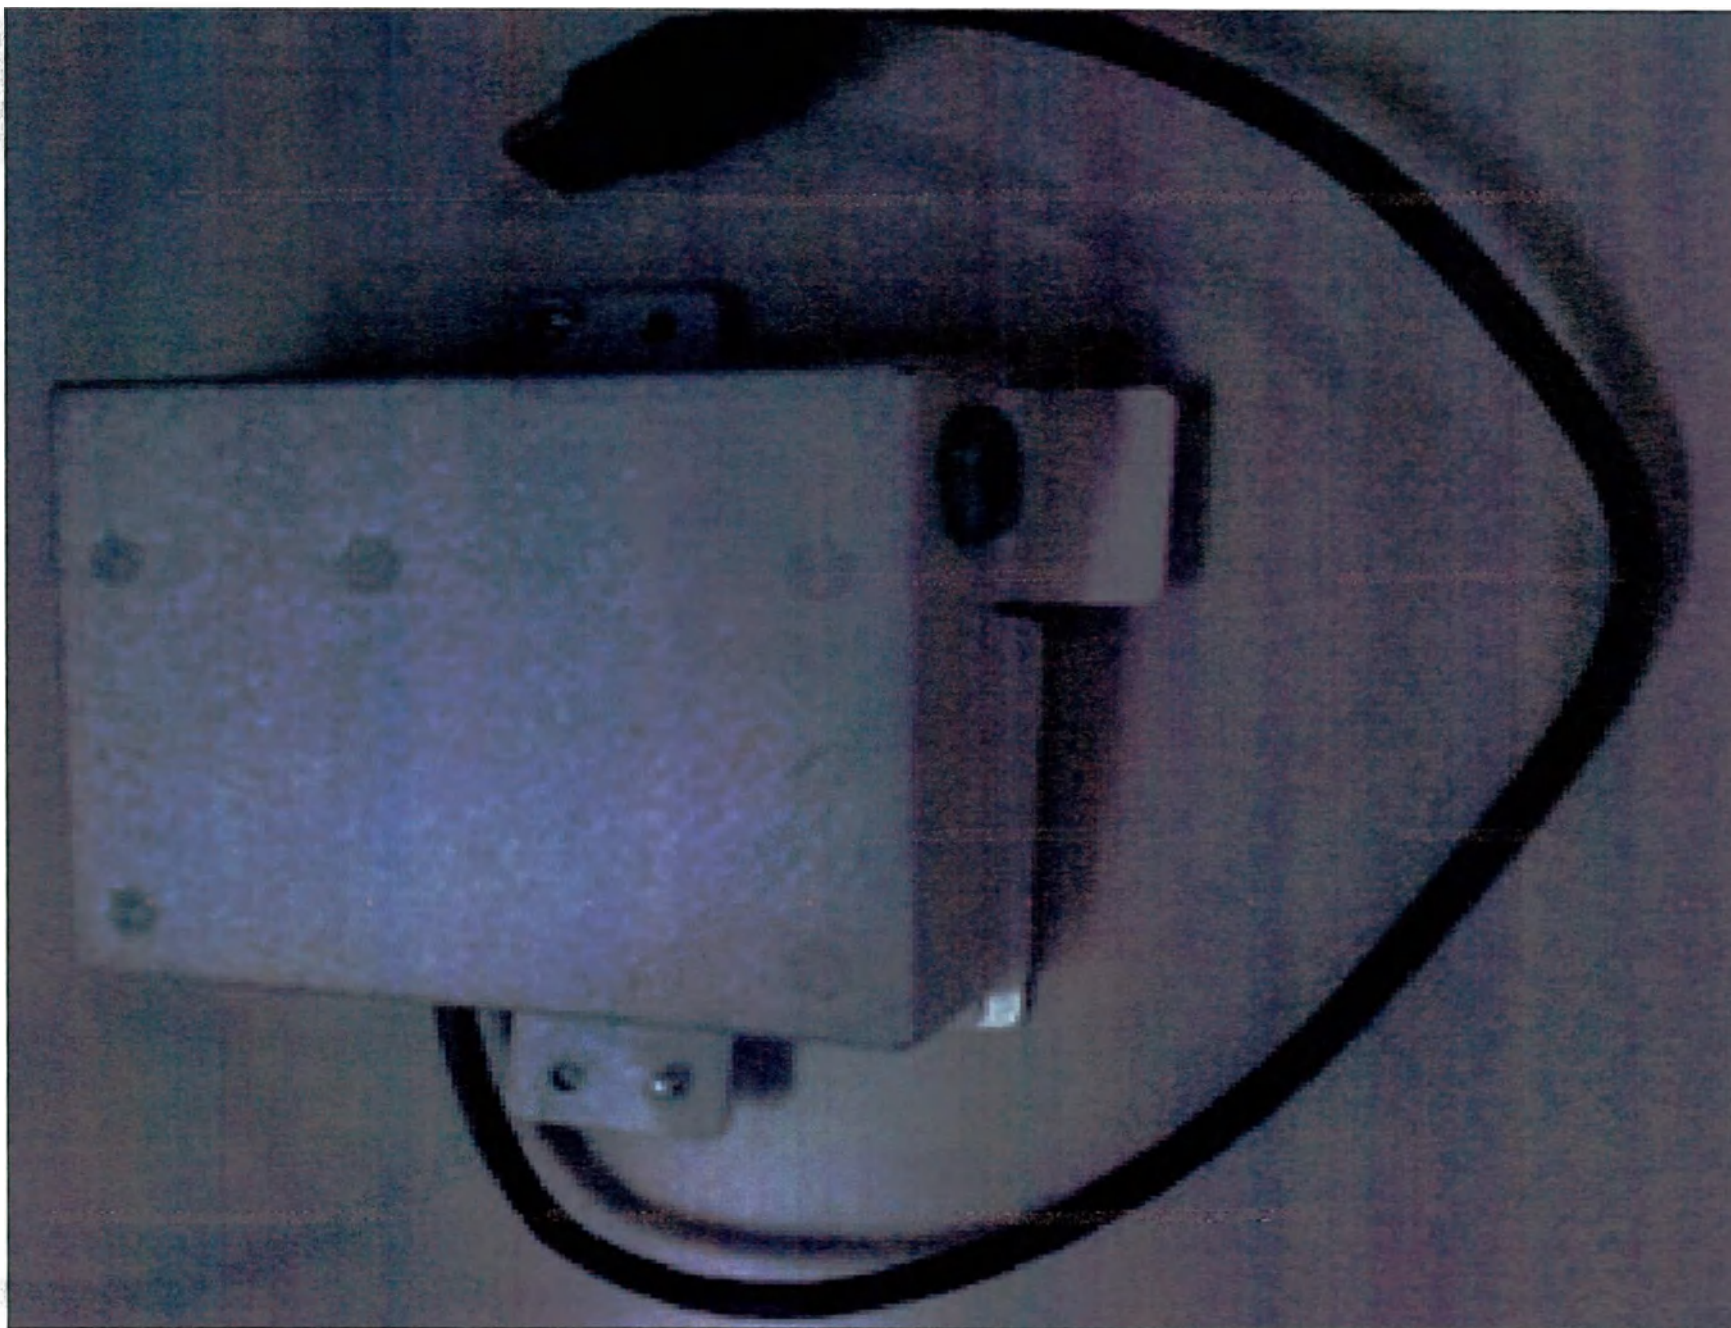

Устройство, обеспечивающее регистрацию физиологических сигналов ЭКГ

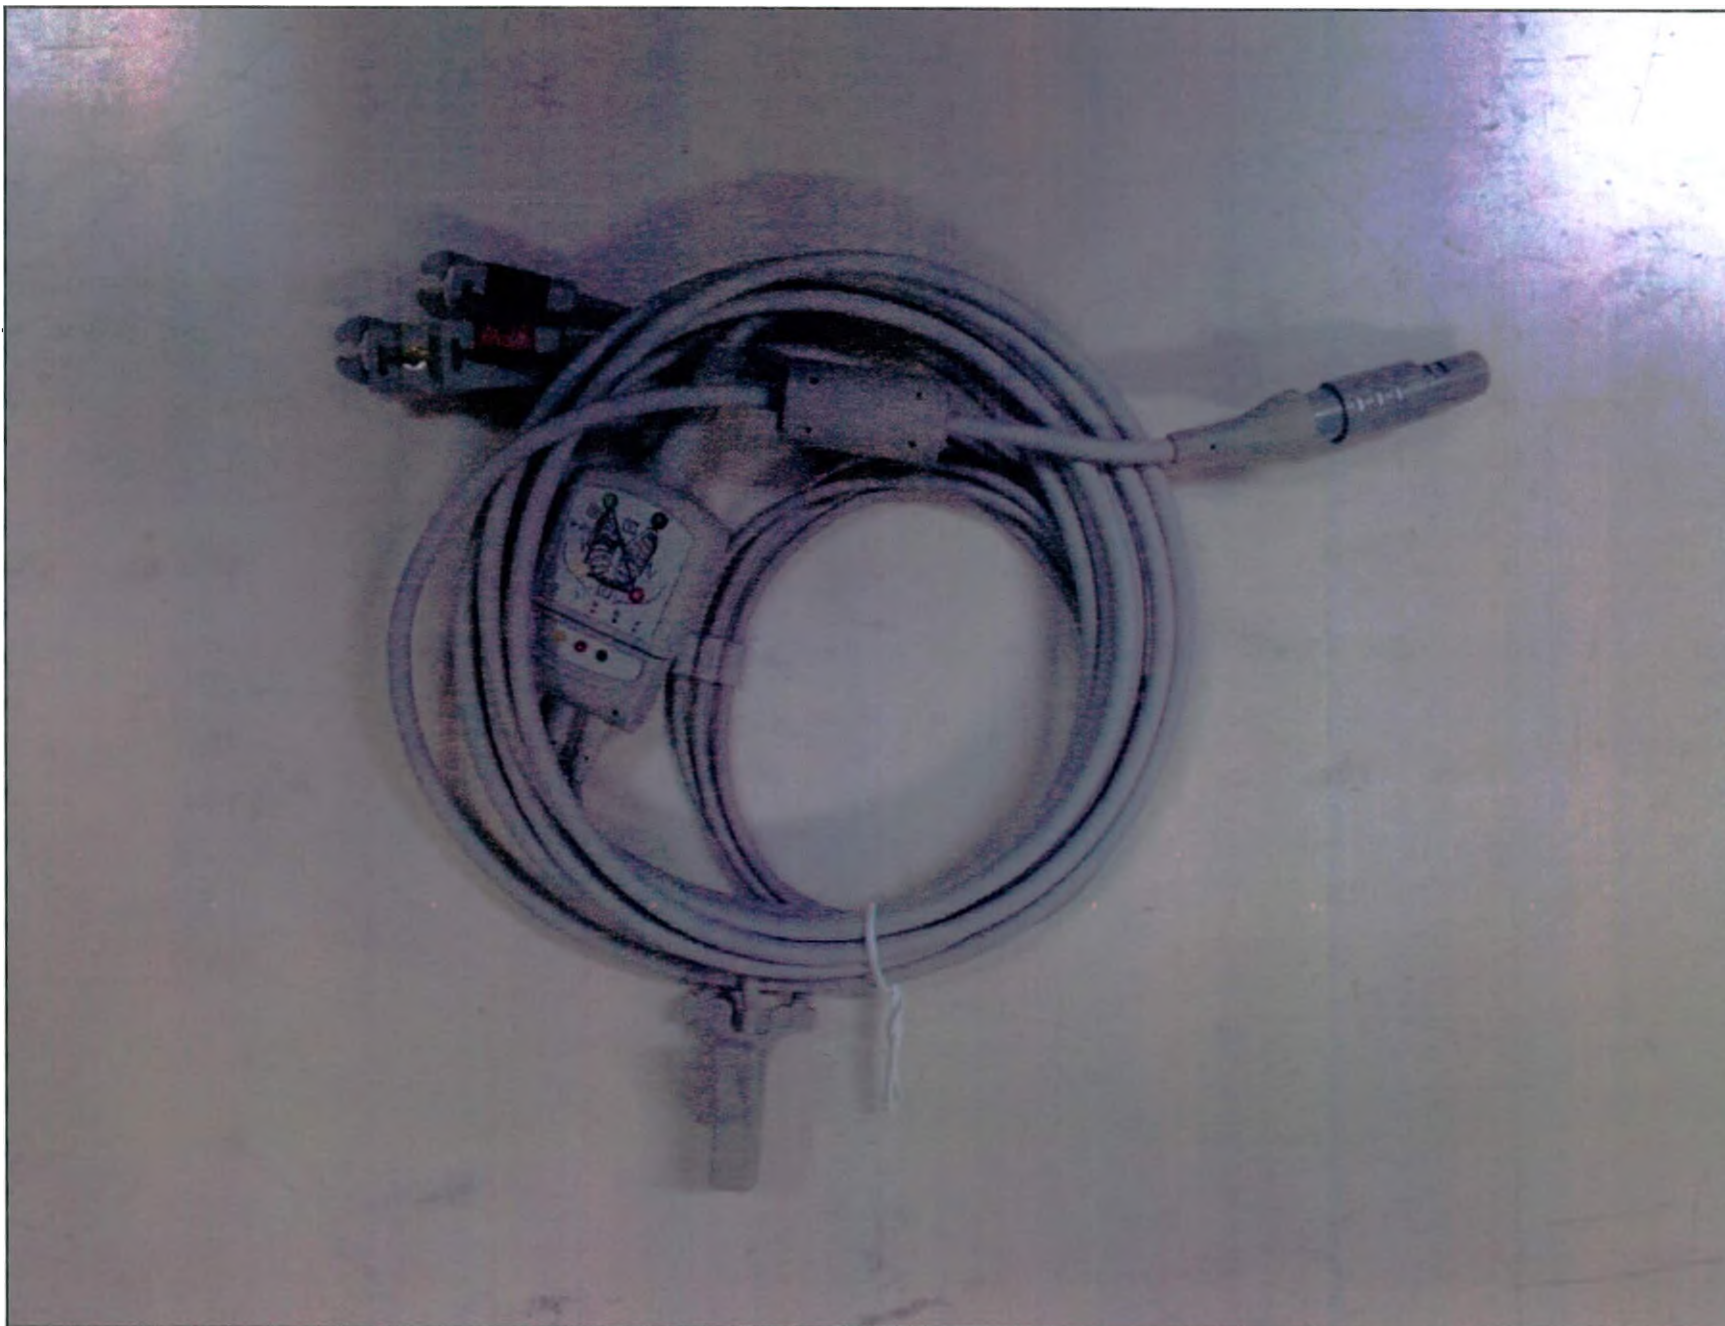


Кабели для устройства, обеспечивающего регистрацию физиологических сигналов ЭКГ

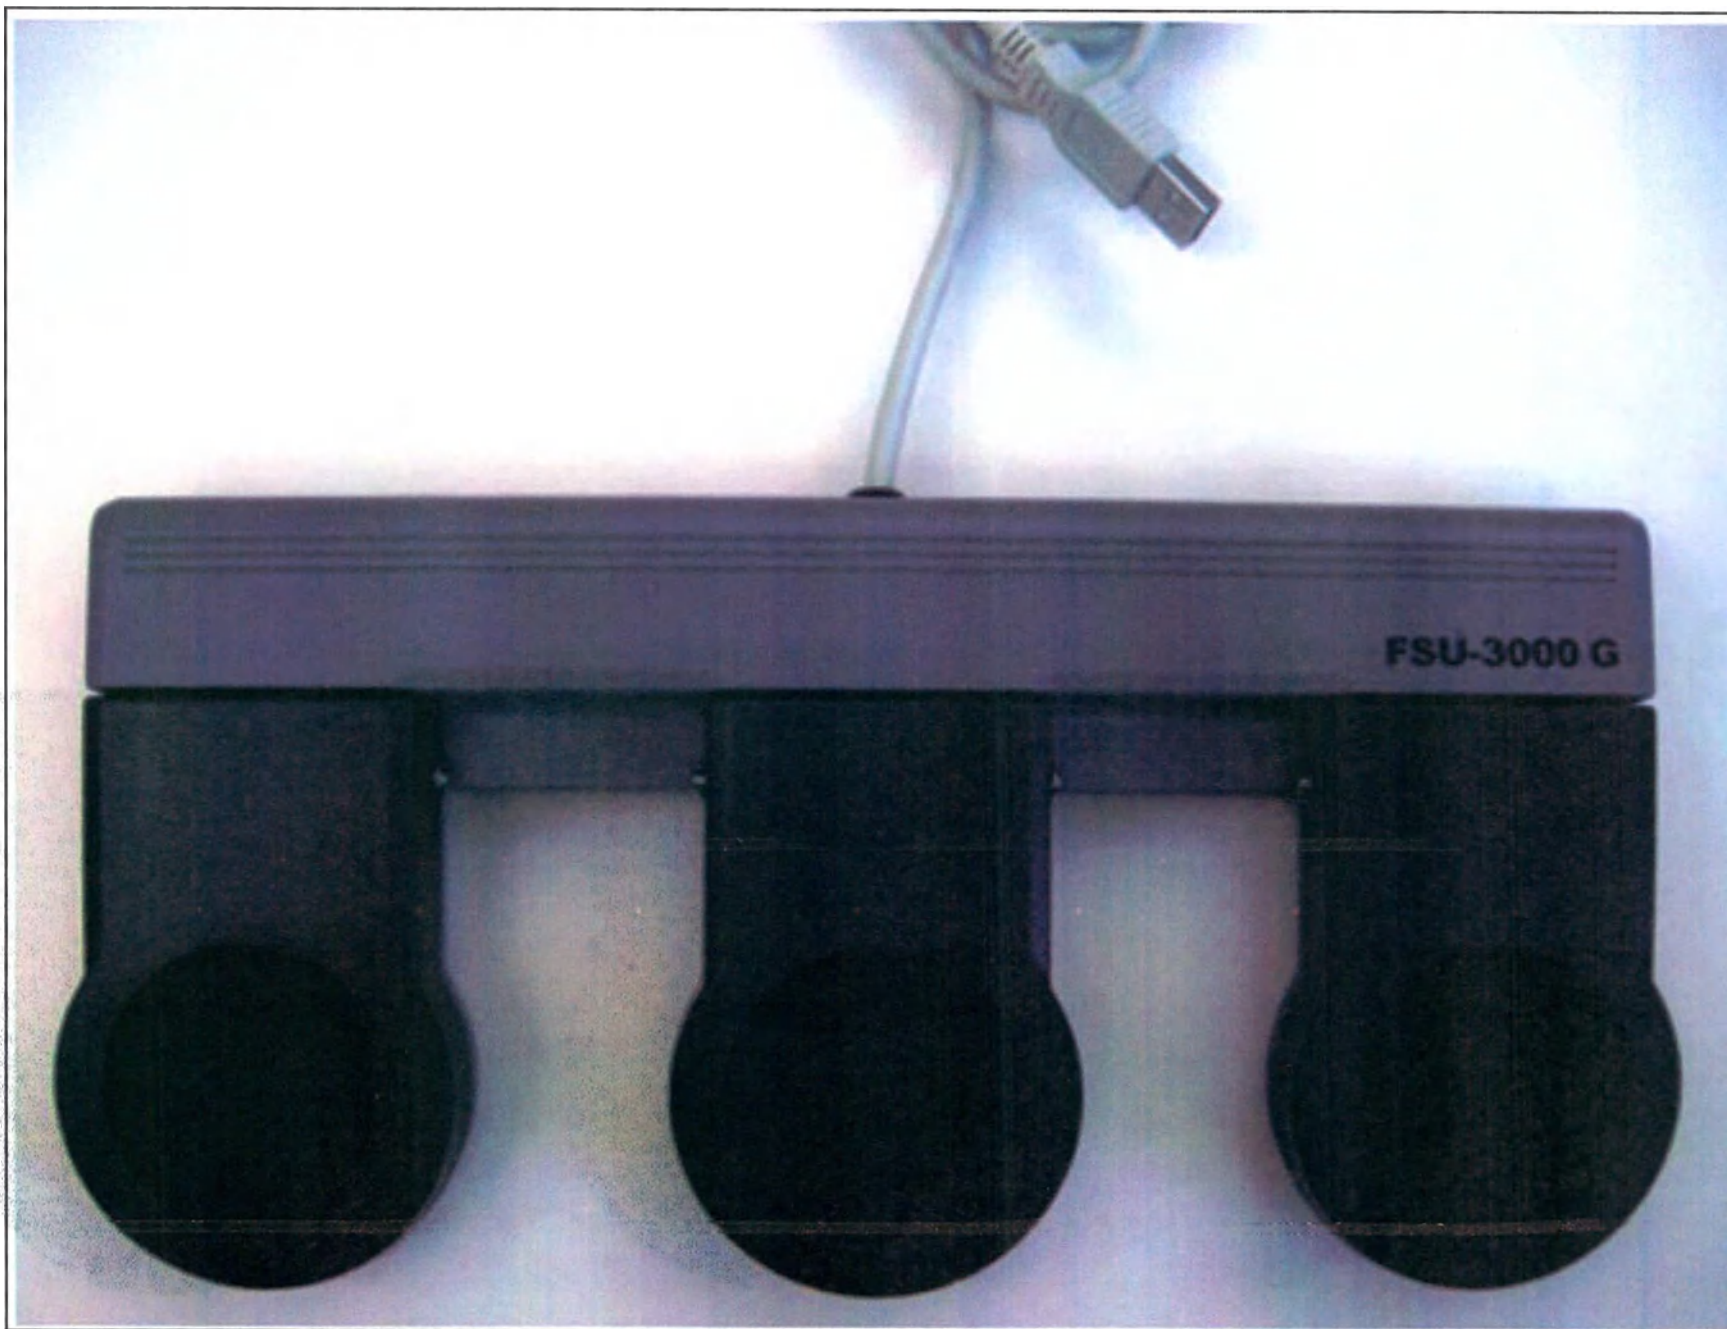


Педальный переключатель Footswitch




Изолирующий трансформатор

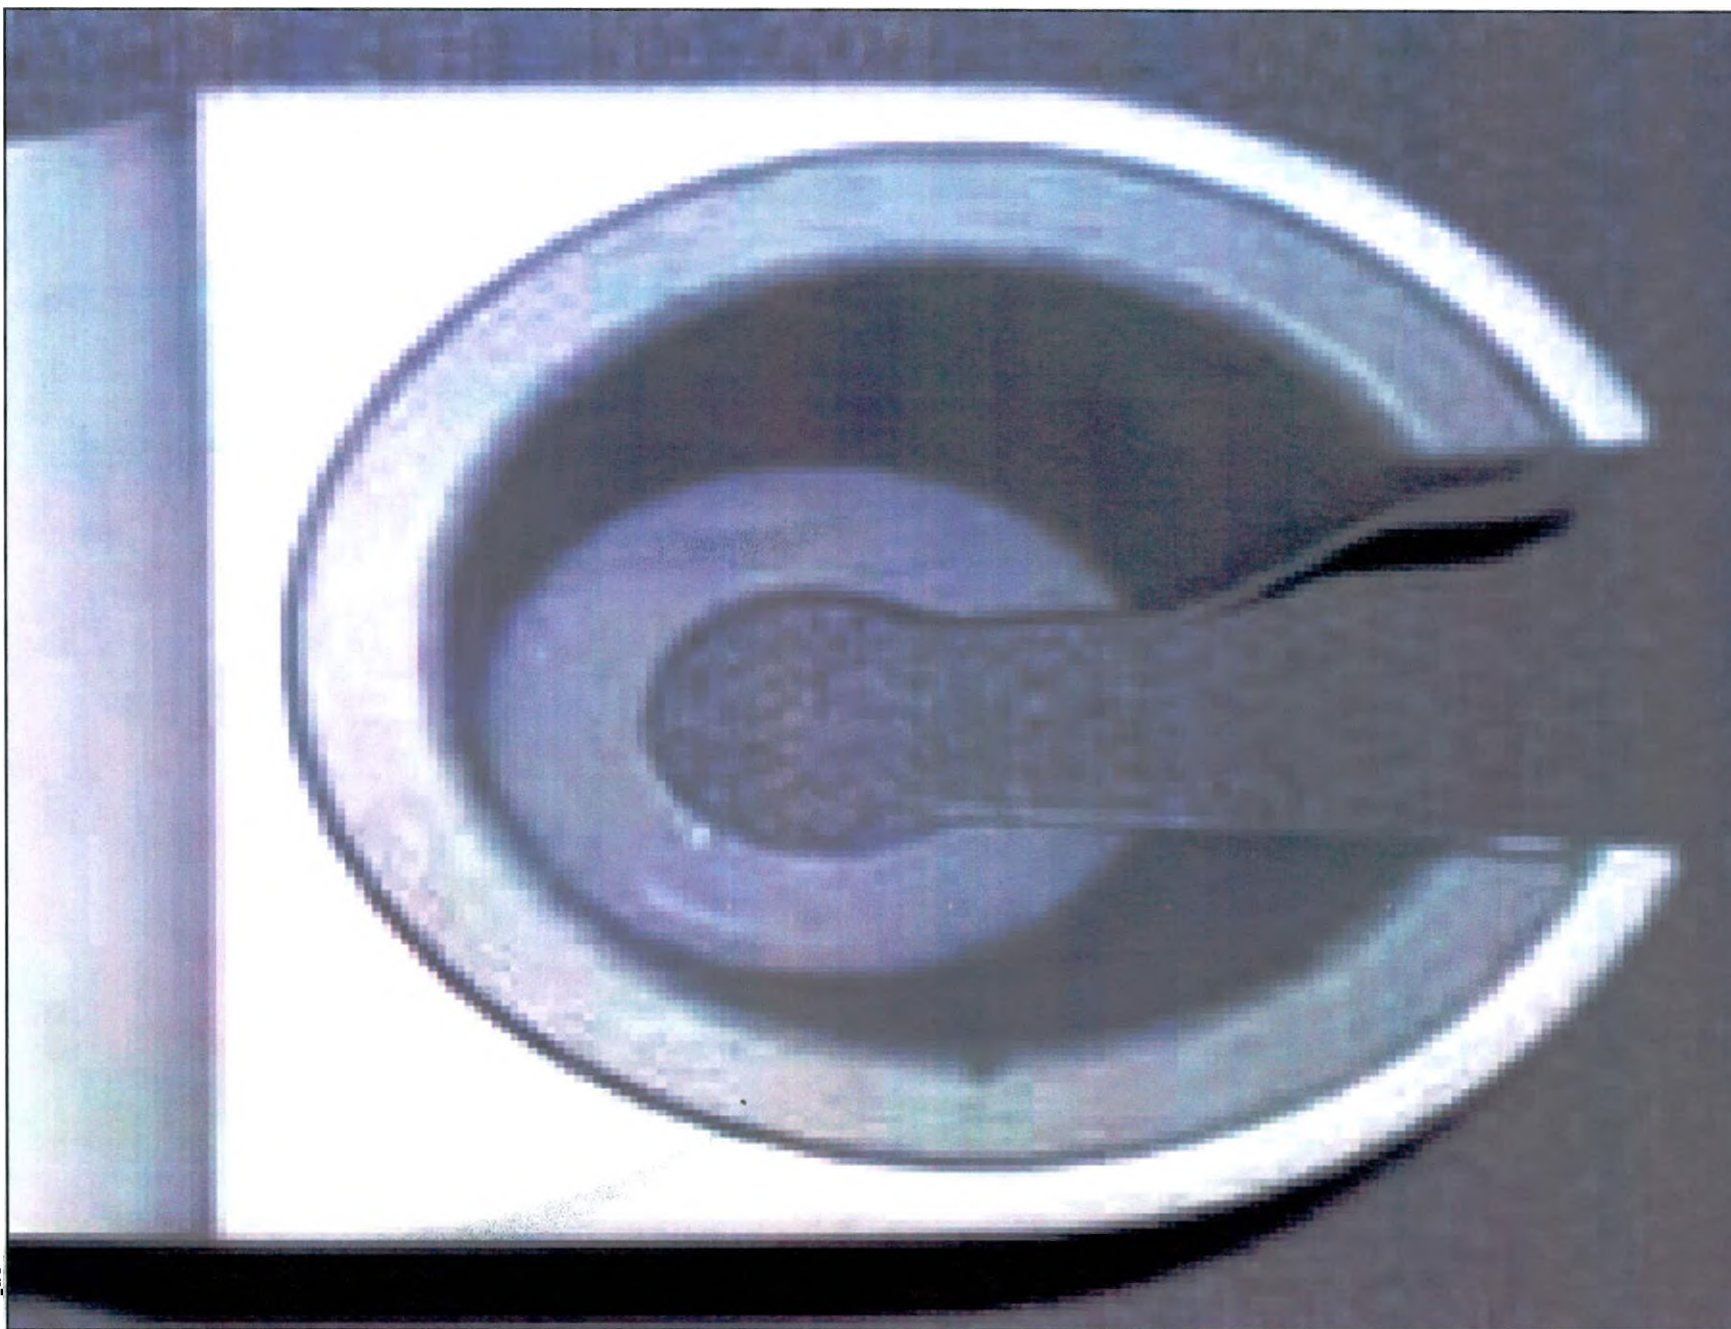


Держатель внутривулостных датчиков

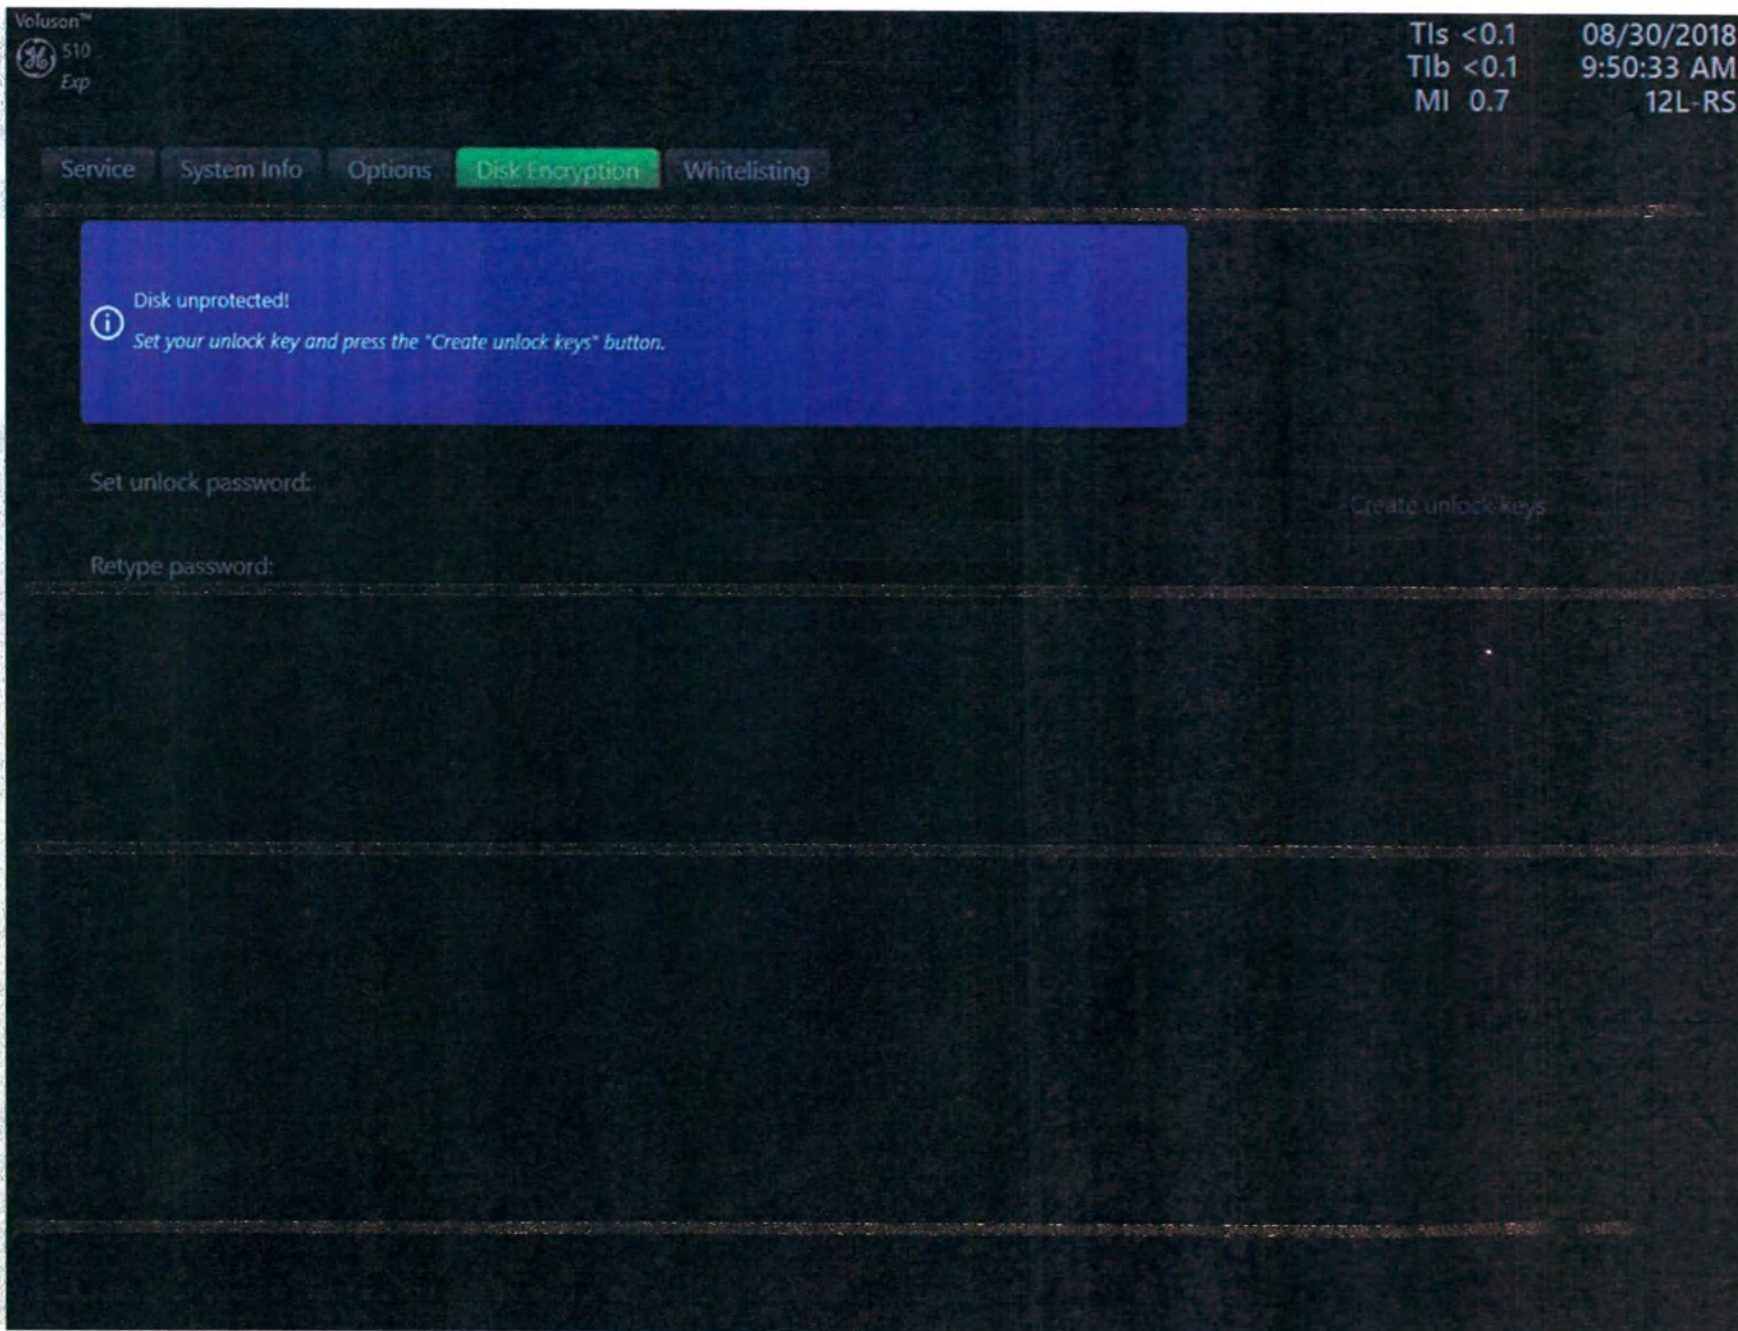


Модуль встроенный, обеспечивающий дополнительную защиту данных

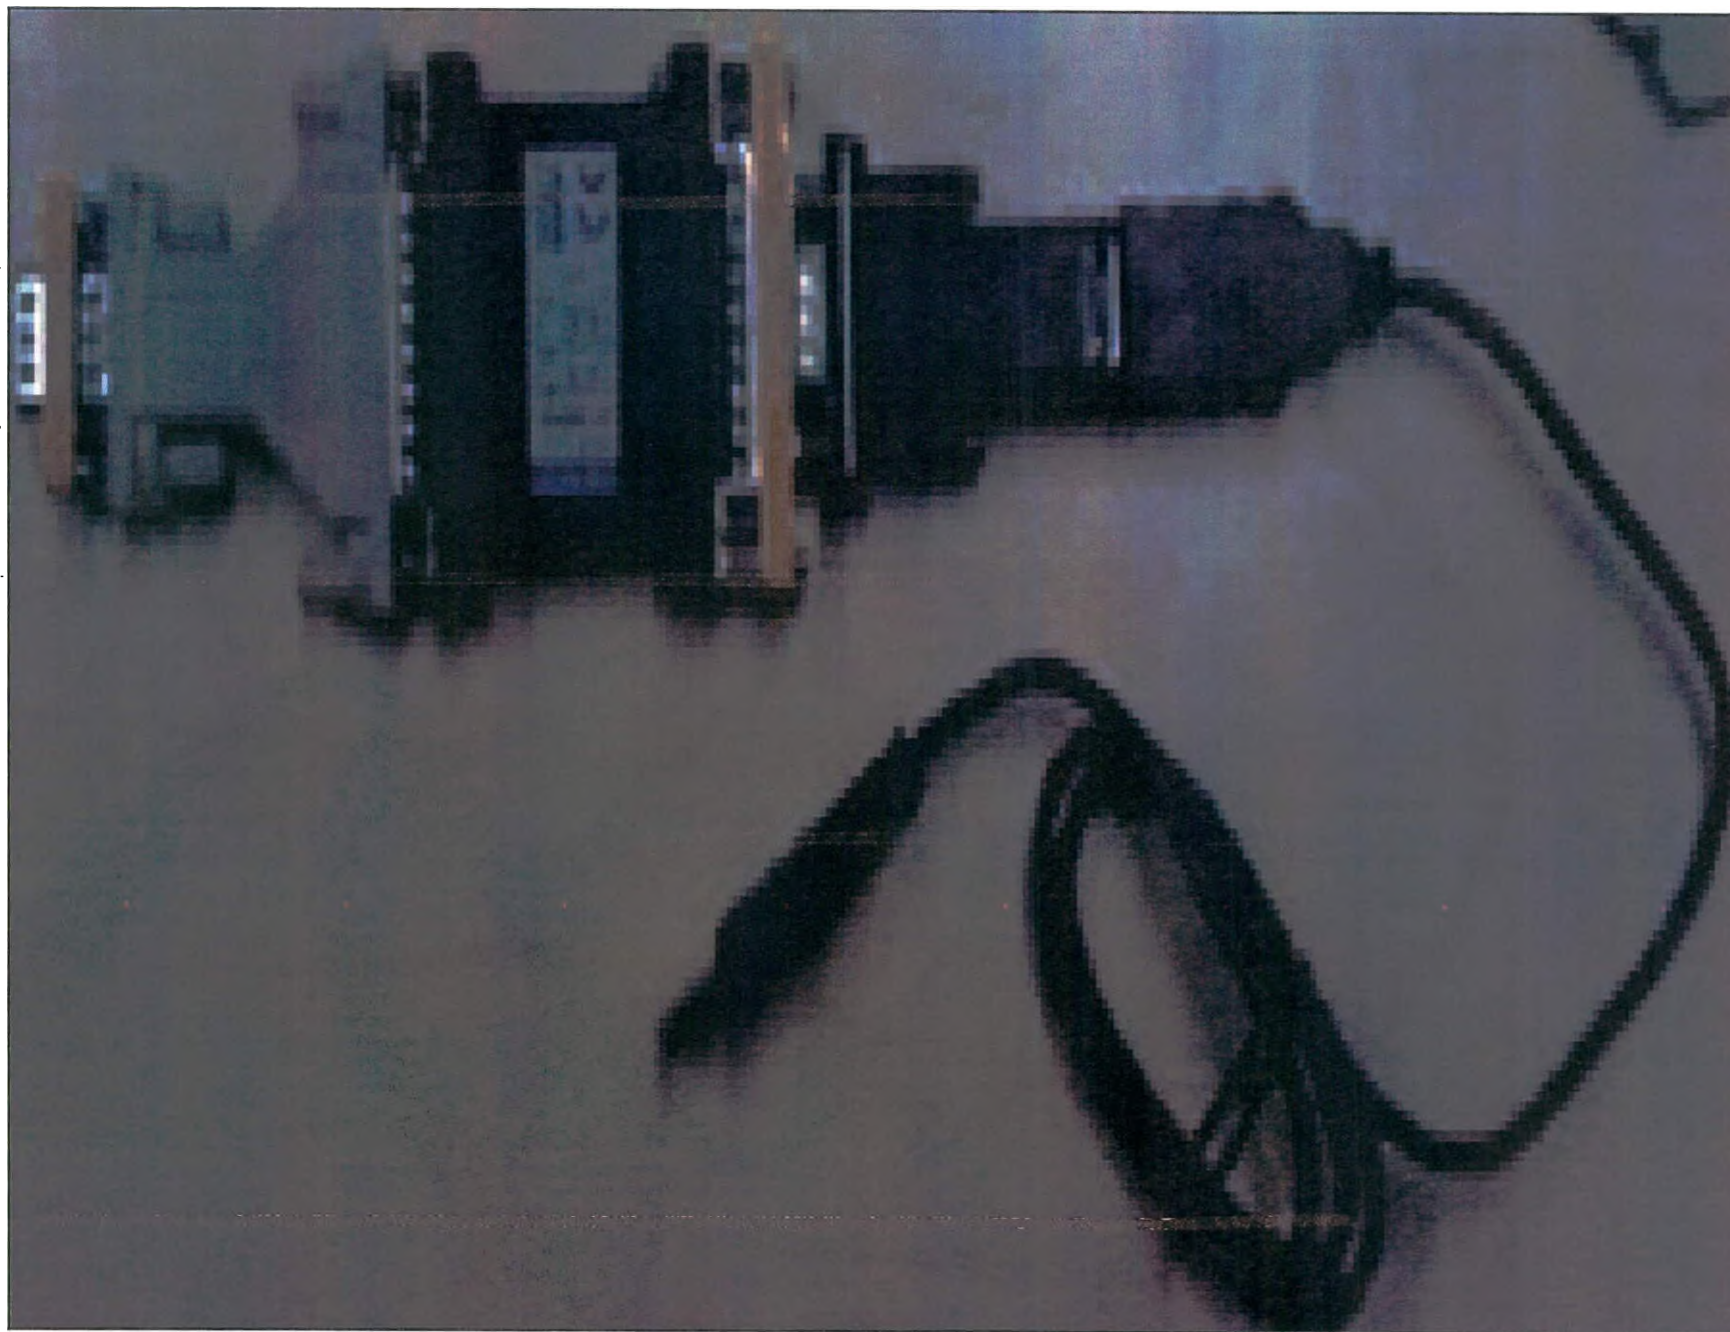

Соединительный модуль

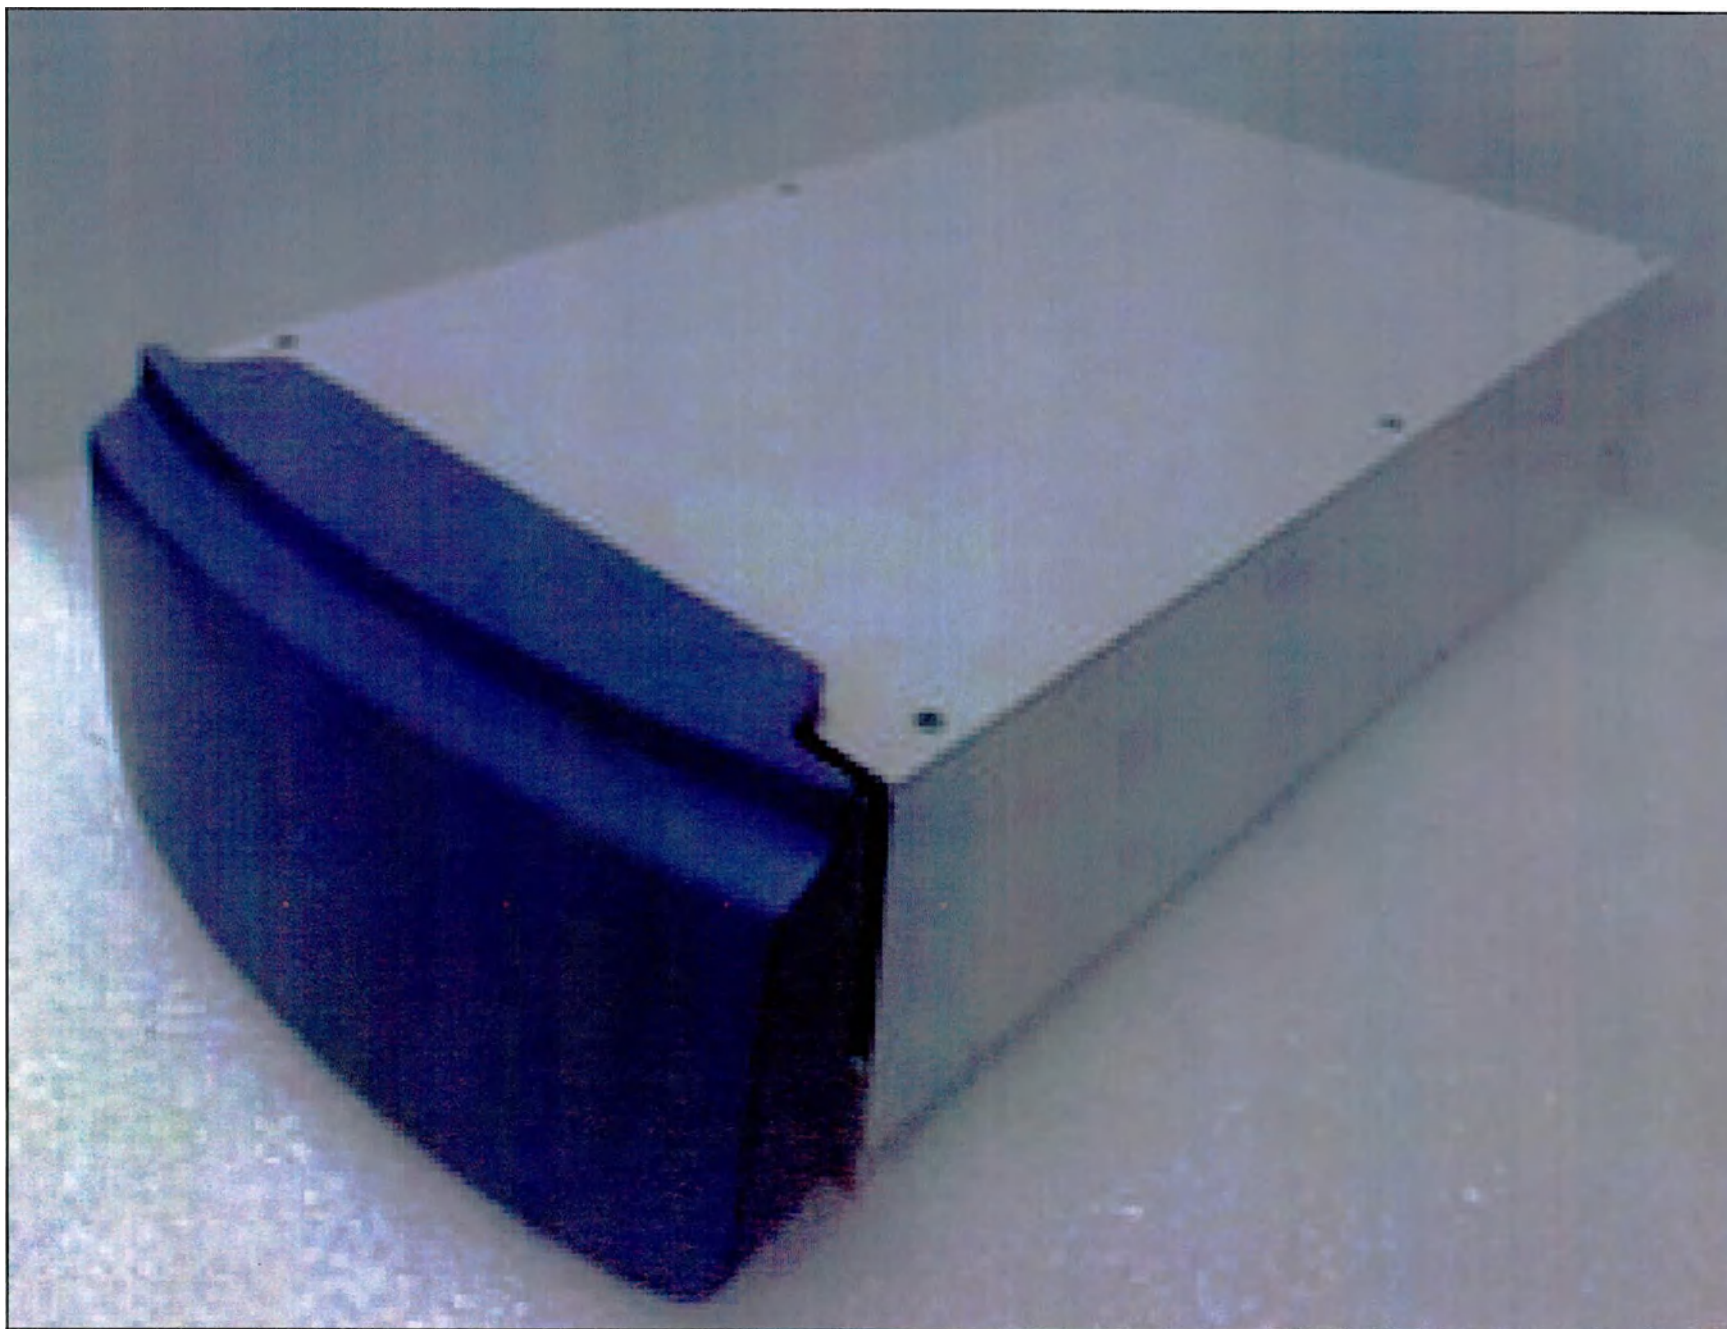

Отсек дополнительный для периферических устройств

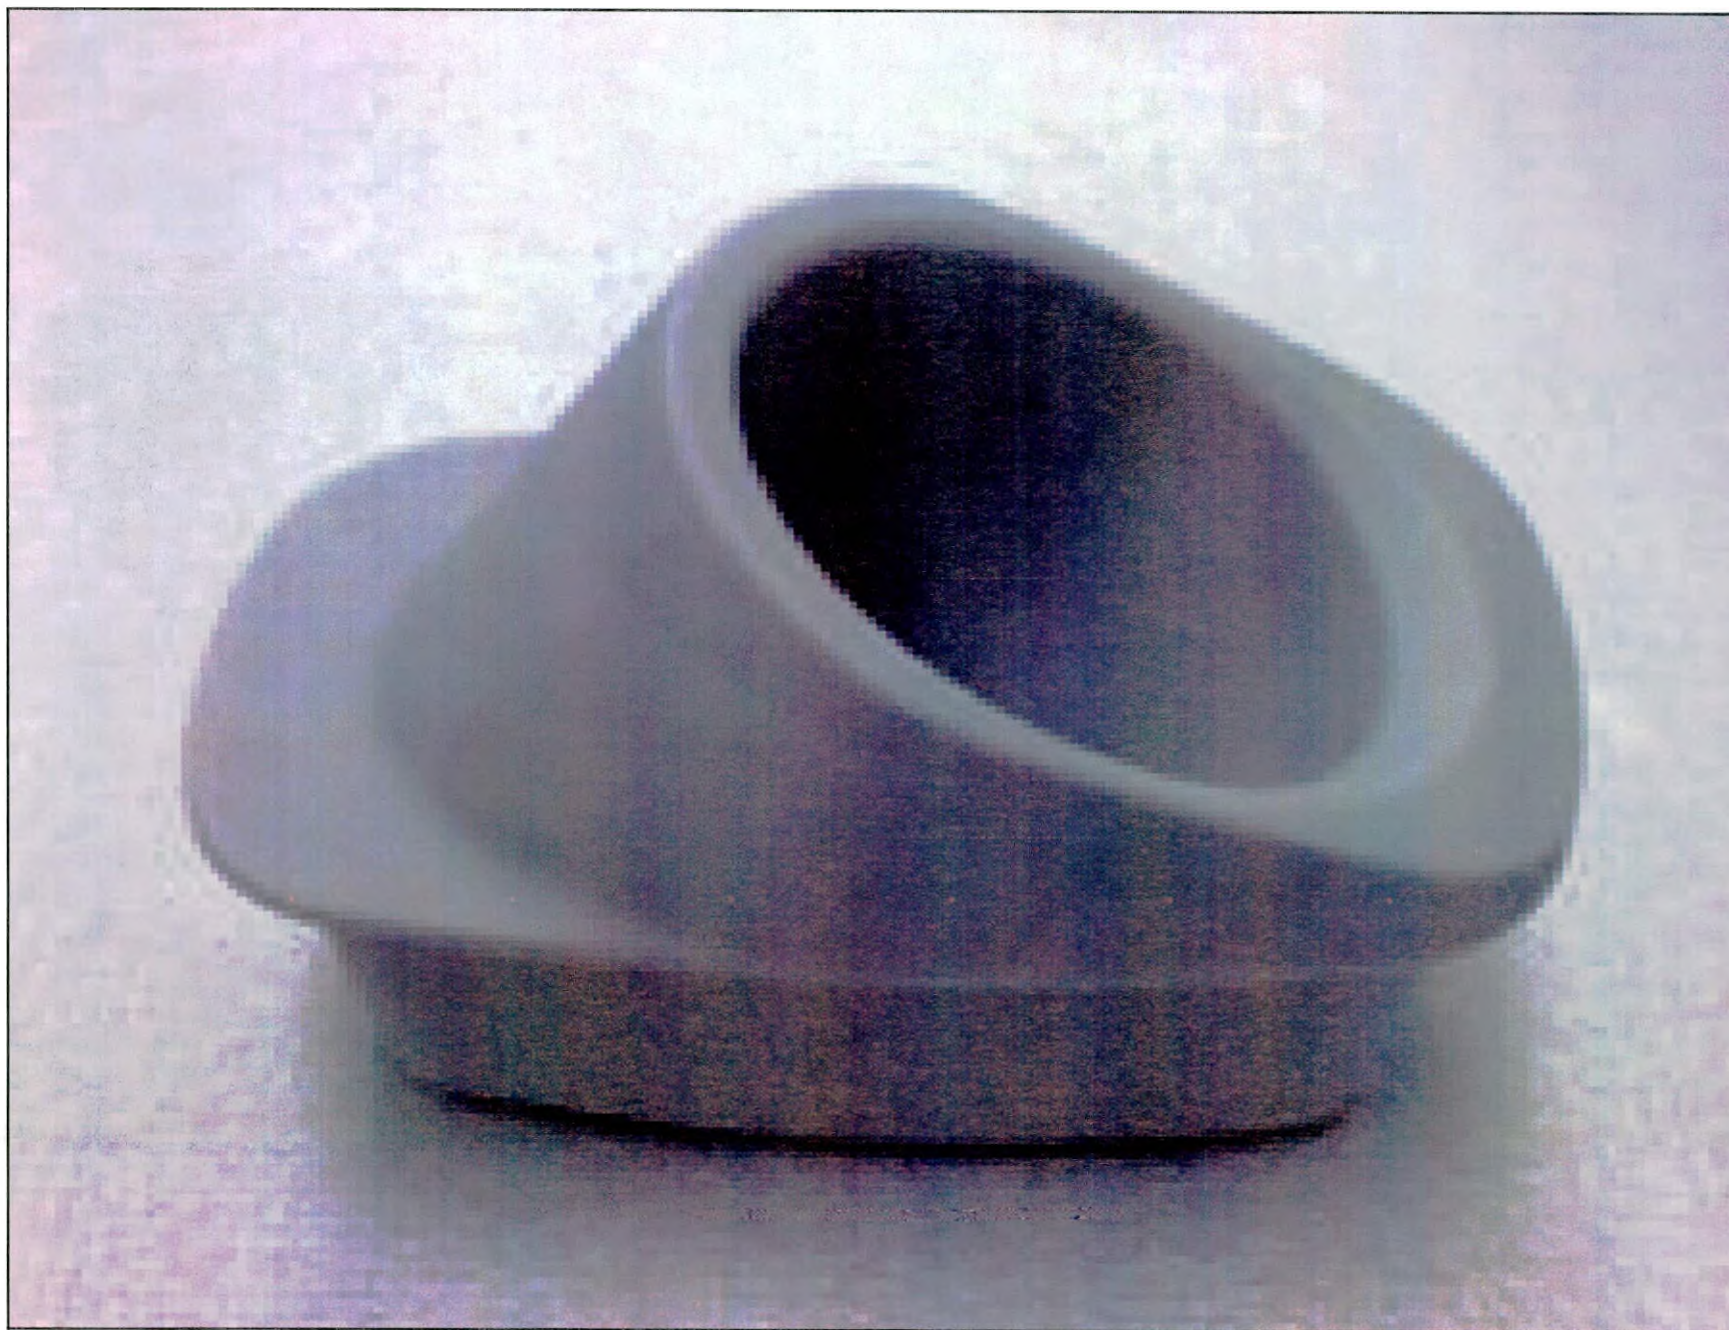


Держатель дополнительный для геля



Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения SONY UP-D897MD и/или SONY UP-D898MD, в комплектации: принтер



Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения SONY UP-D897MD и/или SONY UP-D898MD, в комплектации: кабель для принтера соединительный

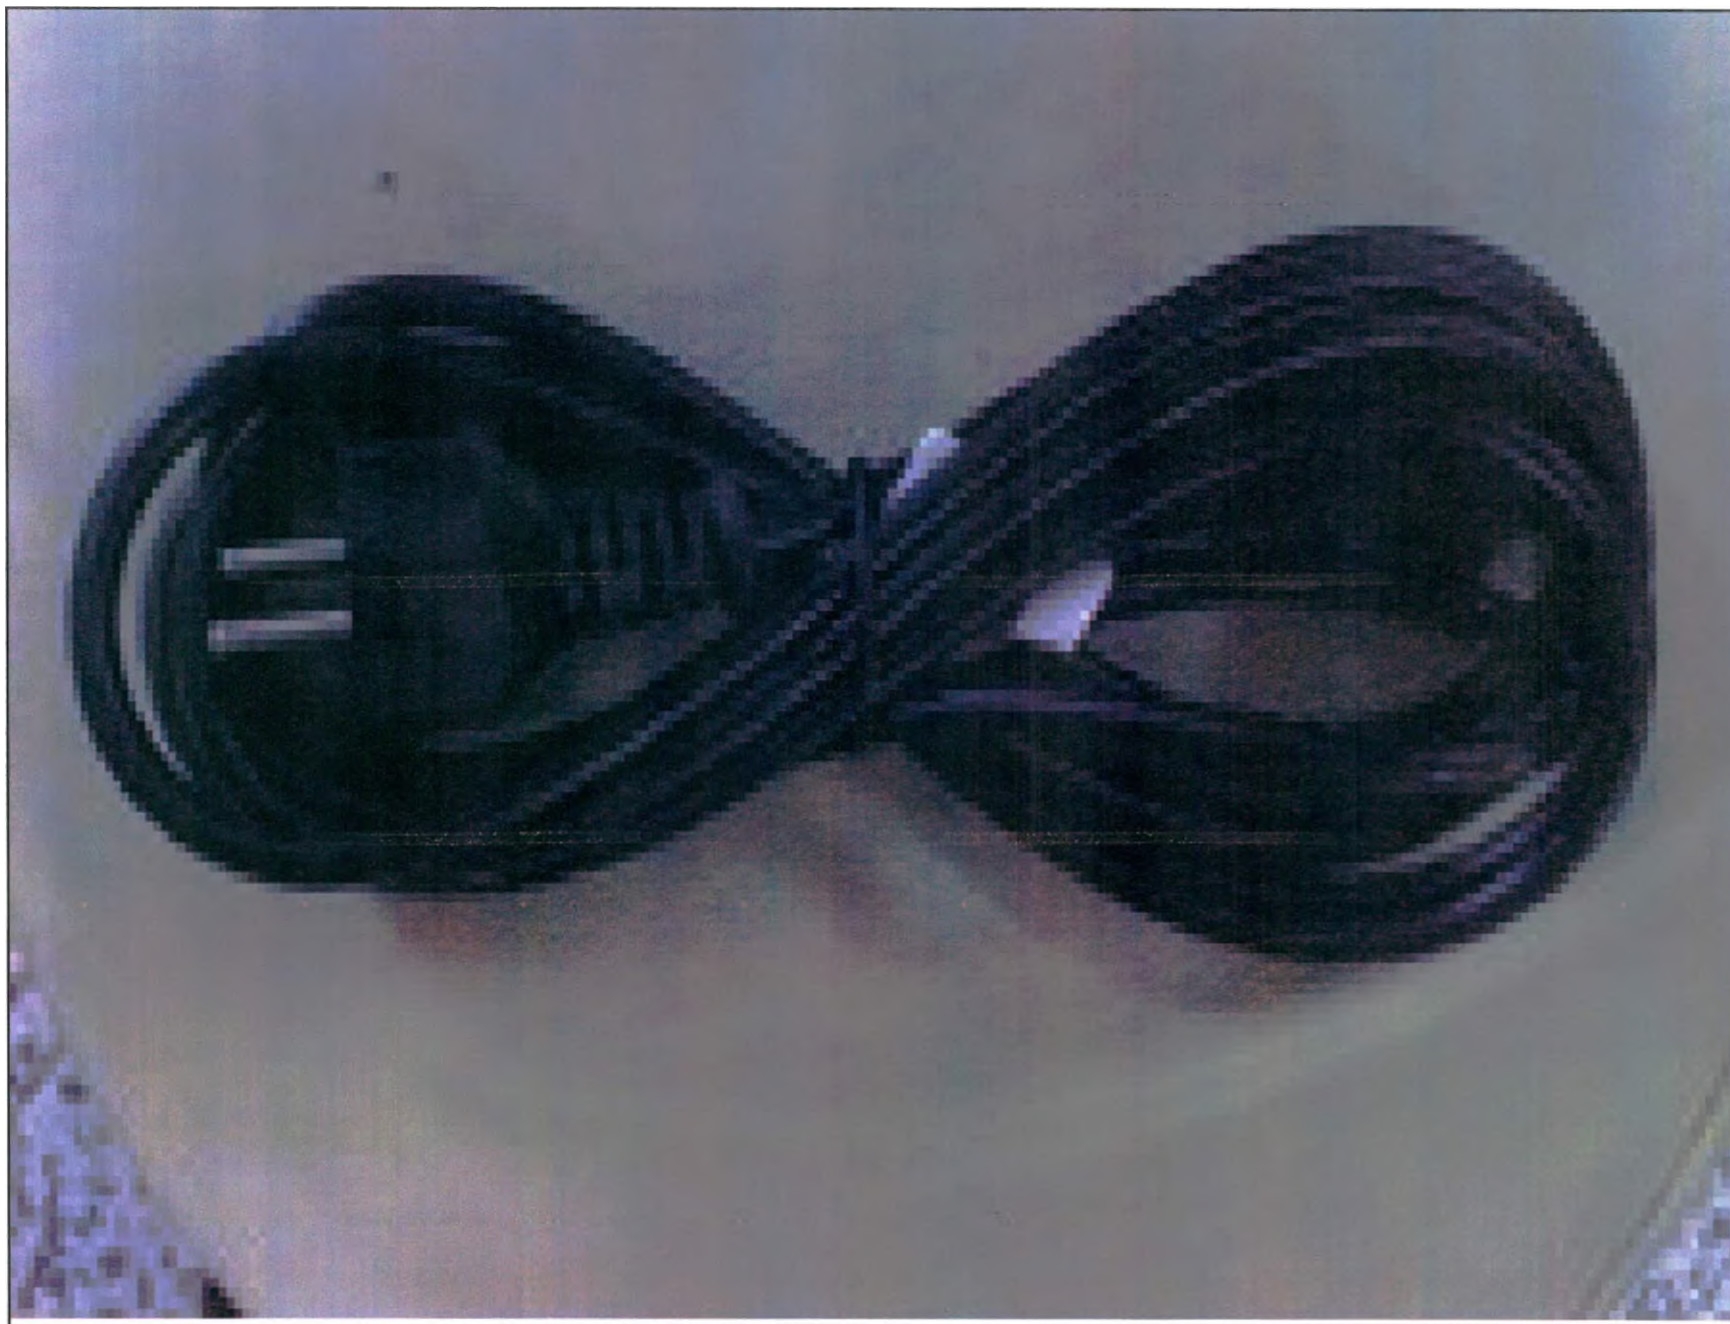

Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения SONY UP-D897MD и/или SONY UP-D898MD, в комплектации: кабель электропитания



Крепление для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения

Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения






Устройство, печатающее цветные ультразвуковые изображения SONY UP-D25MD, в комплектации: принтер




Устройство, печатающее цветные ультразвуковые изображения SONY UP-D25MD, в комплектации: кабель для принтера соединительный

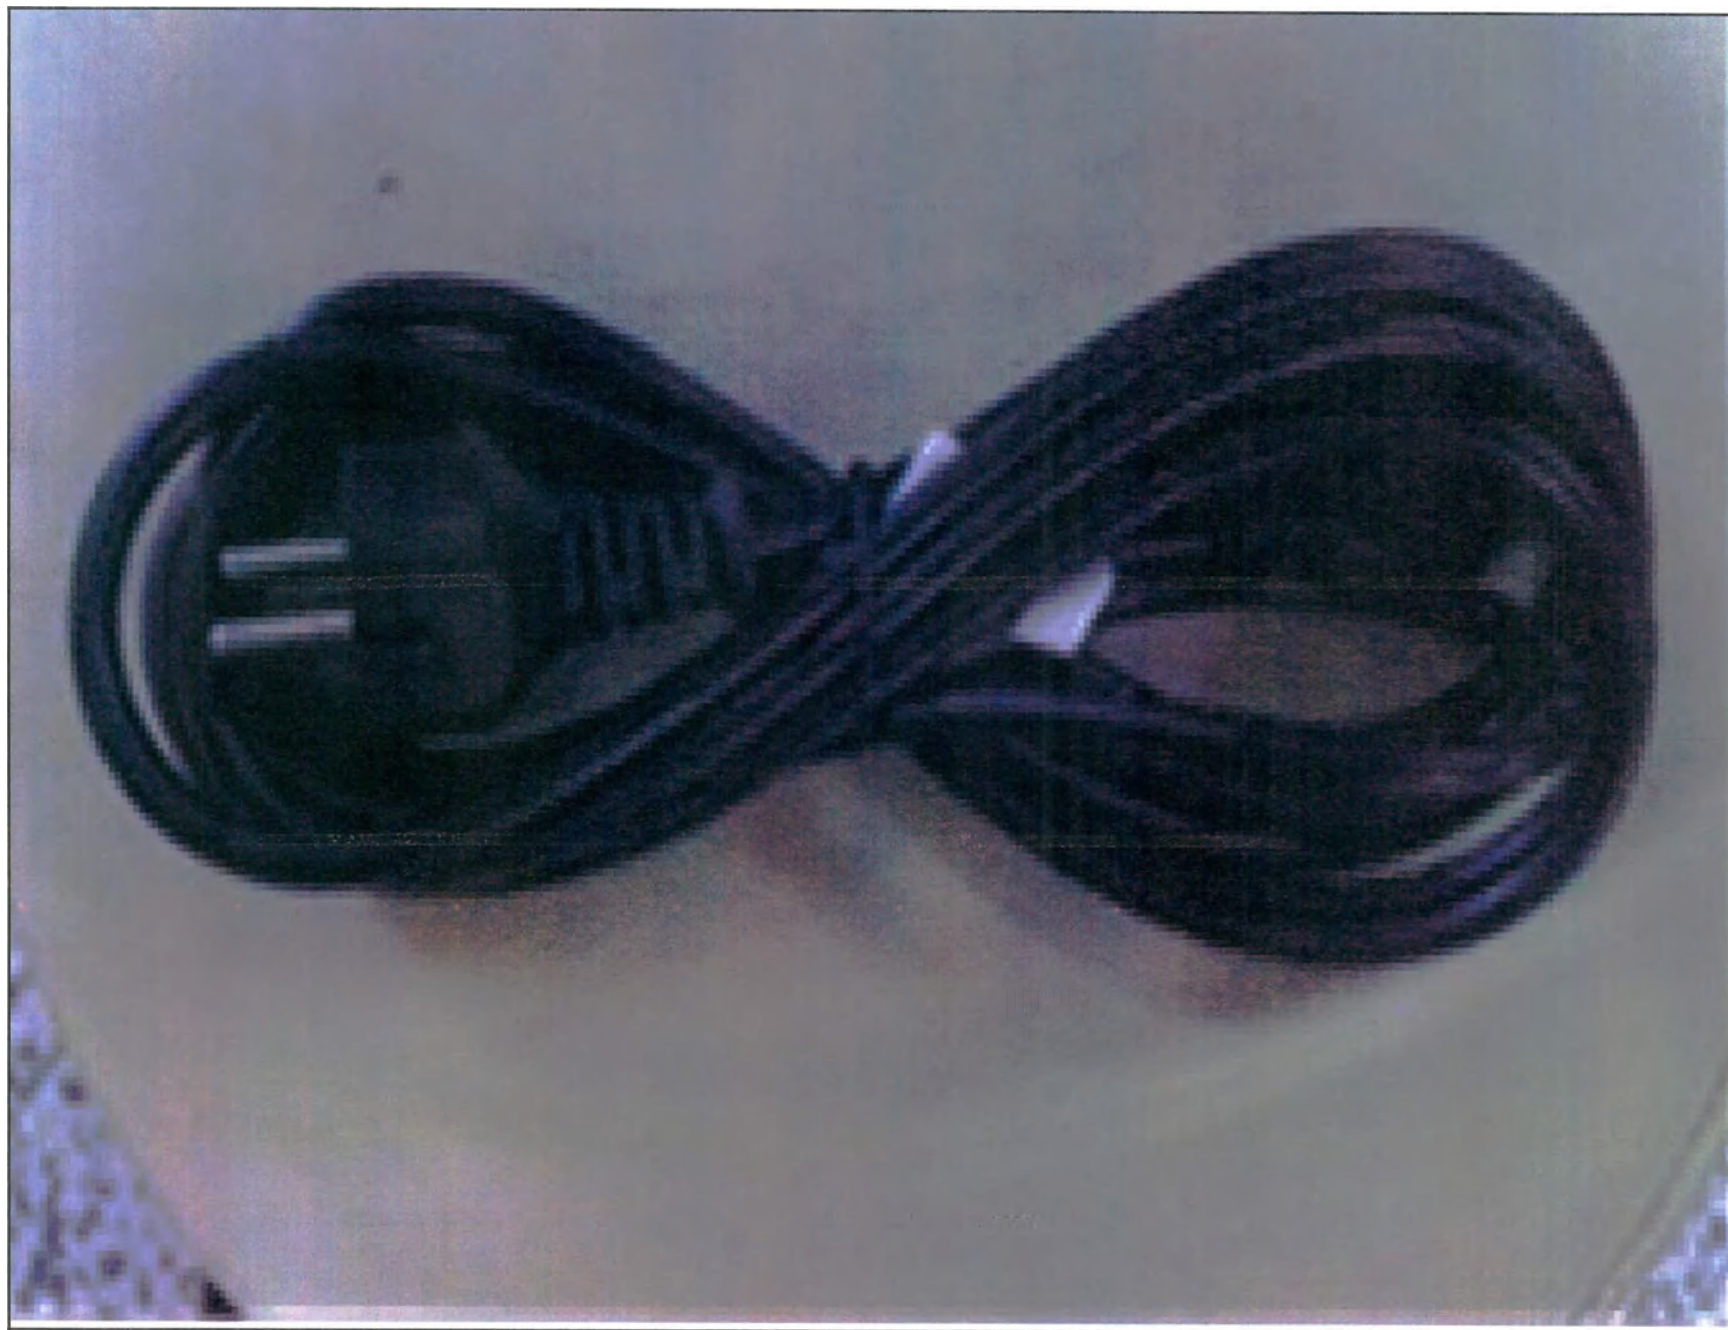

Устройство, печатающее цветные ультразвуковые изображения SONY UP-D25MD, в комплектации: кабель электропитания



Крепление для устройства, печатающего цветные ультразвуковые изображения

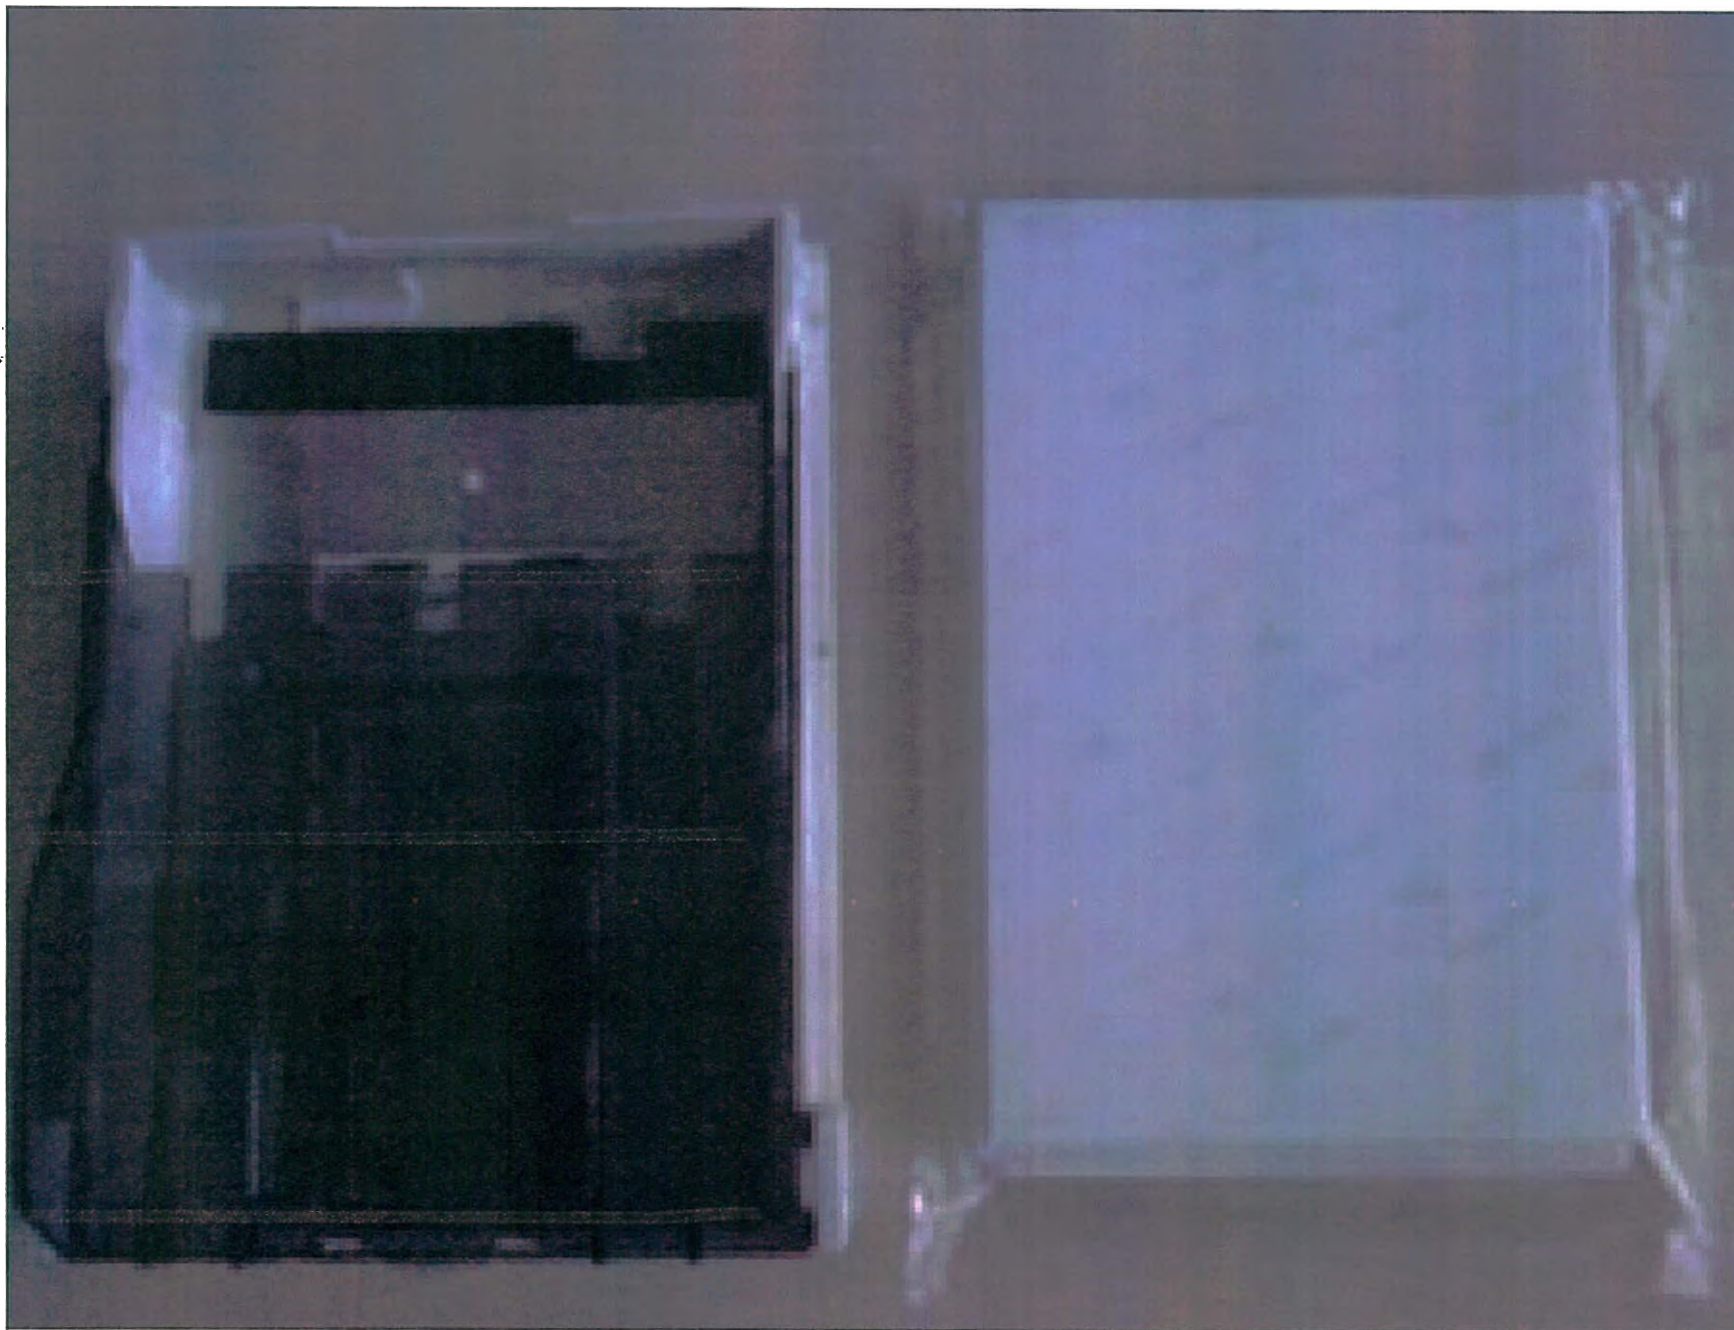

Бумага для устройства, печатающего цветные ультразвуковые изображения




Устройство для конвертации видео в цифровые форматы



Устройство для беспроводной передачи данных



USB карта для записи ультразвуковых изображений

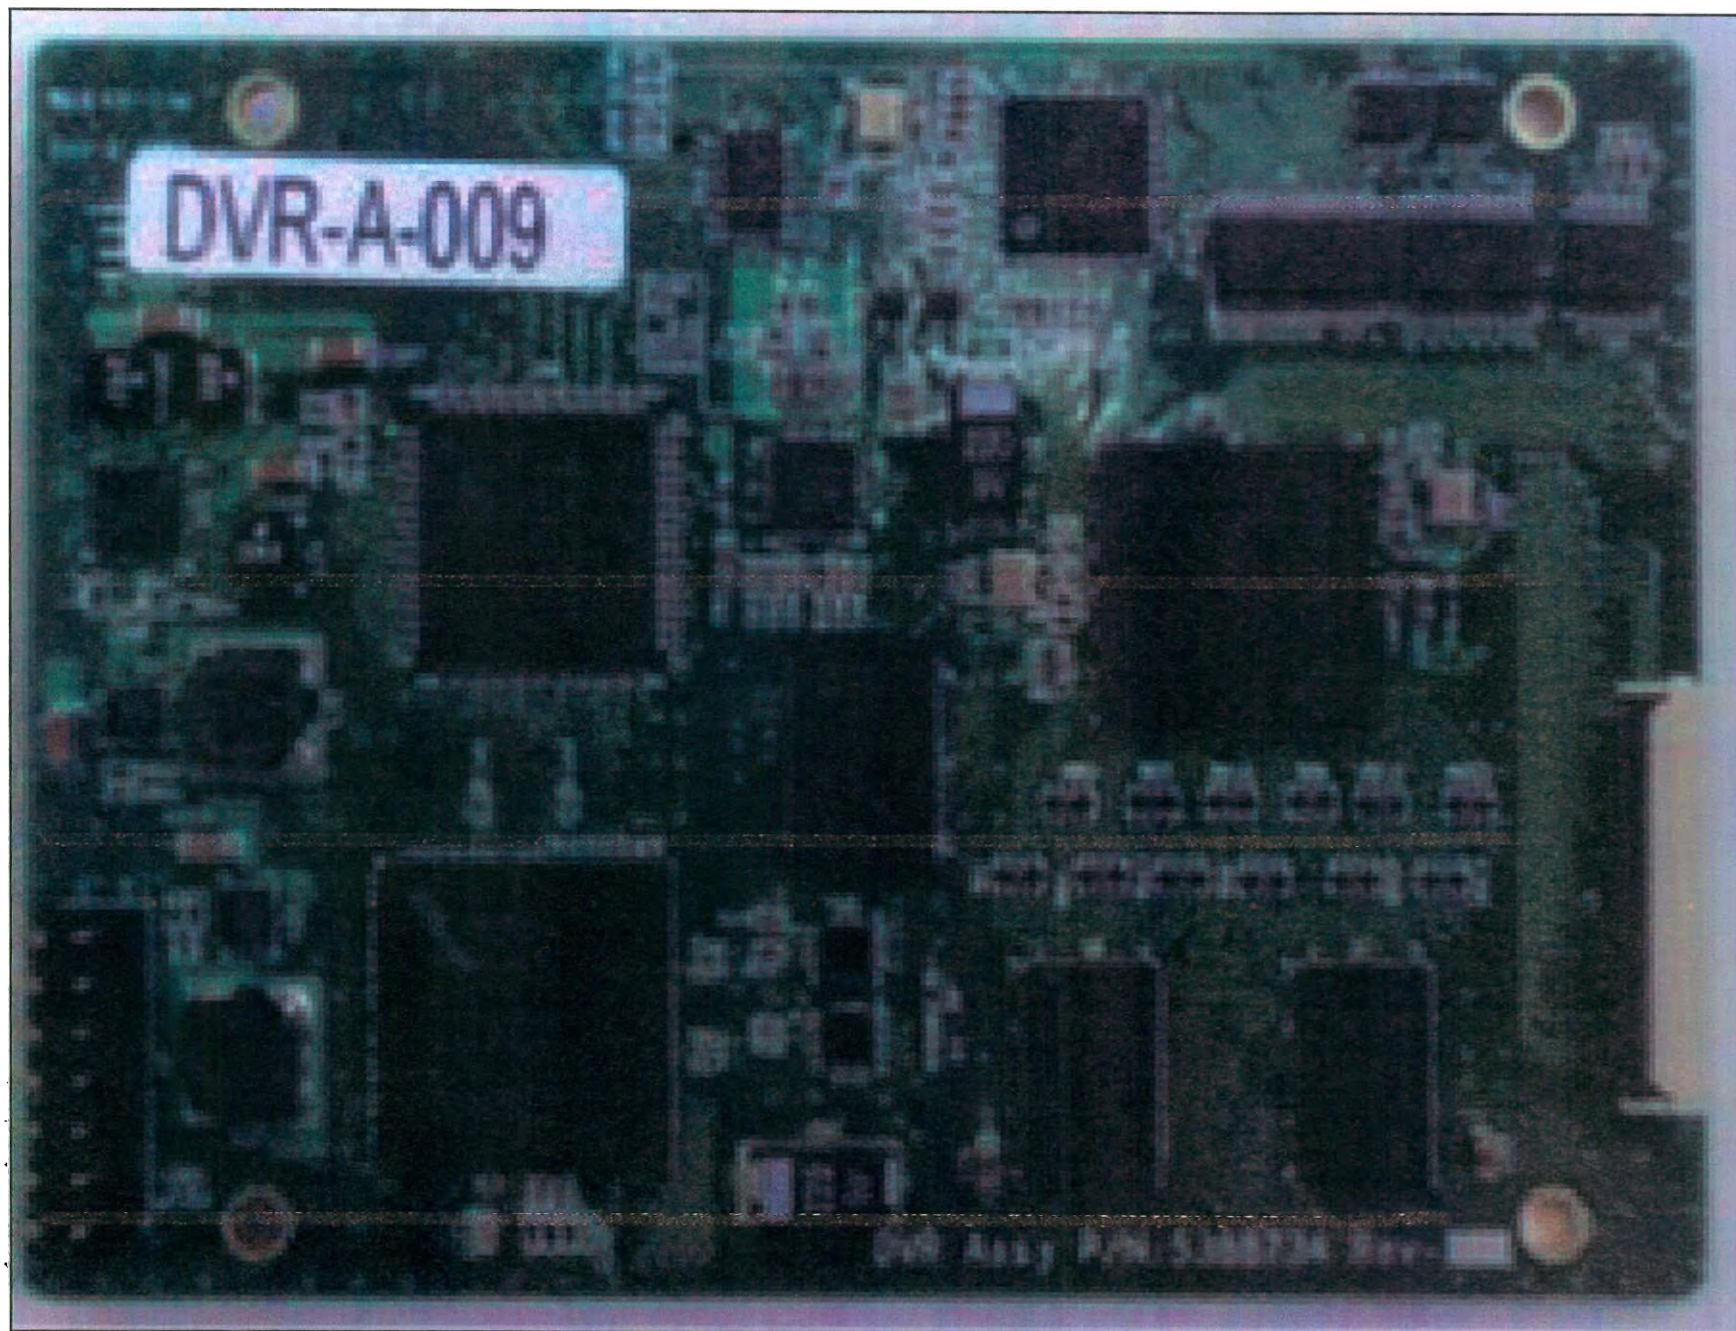

Модуль цифровой видеозаписывающий DVR



USB изоляционное устройство



Защитный кронштейн сетевого кабеля



Всего прошито, пронумеровано,

(102) листов

Директор департамента

Регистрации и сертификации,

Россия и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

А.П. Харитонova