


Фотографические изображения медицинского изделия и маркировка медицинского изделия
«Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови
CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

(Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Switzerland, Швейцария)

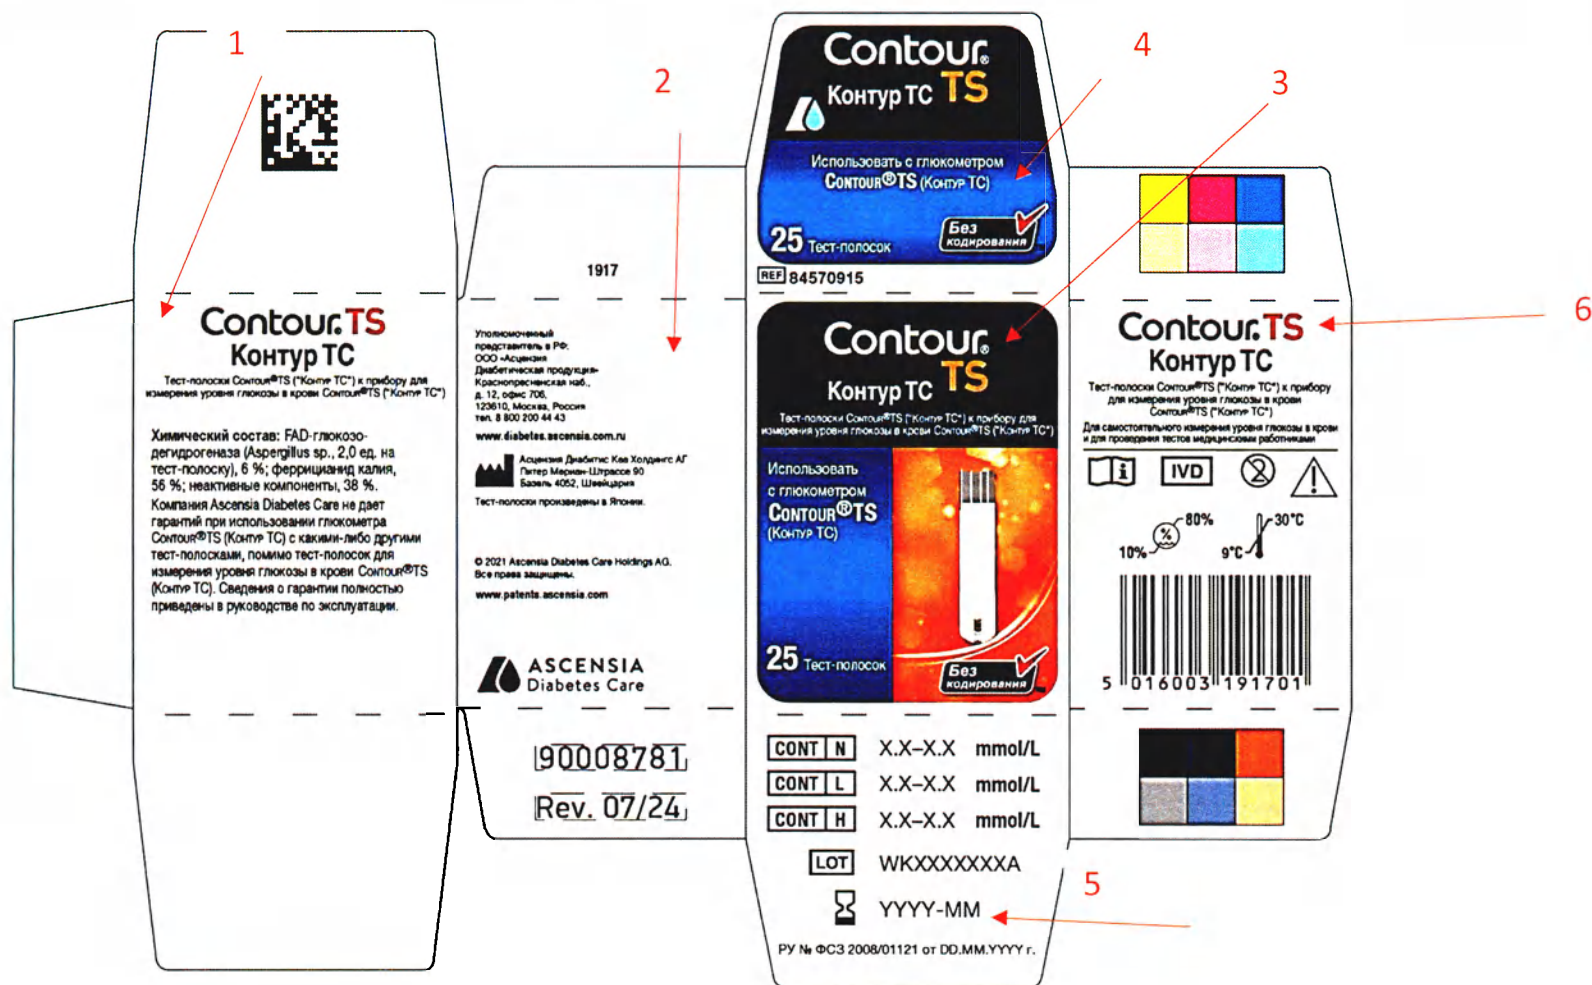

Маркировка потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур TC") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур TC")», 25 тест полосок

Contour[®] TS

Контур ТС

Тест-полоски Contour[®]TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови Contour[®]TS ("Контур ТС")

Химический состав: FAD-глюкозо-дегидрогеназа (Aspergillus sp., 2,0 ед. на тест-полоску), 6 %; феррицианид калия, 56 %; неактивные компоненты, 38 %.

Компания Ascensia Diabetes Care не дает гарантий при использовании глюкометра Contour[®]TS (Контур ТС) с какими-либо другими тест-полосками, помимо тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови Contour[®]TS (Контур ТС). Сведения о гарантии полностью приведены в руководстве по эксплуатации.

Маркировка (1) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")», 25 тест полосок

1917

Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «Асцензия»
Диабетическая продукция
Краснопресненская наб.,
д. 12, офис 706,
120610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com.ru

 Асцензия Диабетис Кэа Холдингс АГ
Питер Мерман-Штрассе 90
Базель 4052, Швейцария
Тест-полоски произведены в Японии.

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Все права защищены.
www.patents.ascensia.com

 **ASCENSIA**
Diabetes Care

90008781

Rev. 07/24

Маркировка (2) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")», 25 тест полосок

Contour® Контур ТС TS

Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")

Использовать
с глюкометром
CONTOUR® TS
(Контур ТС)

25 Тест-полосок



Без
кодирования



Маркировка (3) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")», 25 тест полосок



Маркировка (4) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")», 25 тест полосок

CONT N X.X-X.X mmol/L

CONT L X.X-X.X mmol/L

CONT H X.X-X.X mmol/L

LOT WKXXXXXXXXA



YYYY-MM

ПУ № ФСЗ 2008/01121 от DD.MM.YYYY г.



Маркировка (5) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")», 25 тест полосок

Contour[®]TS

Контур ТС

Тест-полоски Contour[®]TS ("Контур ТС") к прибору
для измерения уровня глюкозы в крови
Contour[®]TS ("Контур ТС")

Для самостоятельного измерения уровня глюкозы в крови
и для проведения тестов медицинскими работниками



Маркировка (6) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")», 25 тест полосок

Contour[®]
Контур ТС TS

Тест-полоски CONTOUR[®]TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®]TS ("Контур ТС")

Без кодирования 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
С ПРИБОРОМ
CONTOUR[®]TS (КОНТУР ТС)

25 ТЕСТ-ПОЛОСОК

REF 84570915

IVD



9°C 30°C



Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ
Питер Мериан-Штрассе 90
Базель 4052, Швейцария

**ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ПЛОТНО
ЗАКРОЙТЕ ФЛАКОН.**

Тест-полоски произведены в Японии.
www.diabetes.ascensia.com.ru

Уполномоченный
представитель в РФ:

ООО «Асцензия
Диабетическая продукция»
Краснопресненская наб.,
д. 12, офис 706,
123610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43



ASCENSIA
Diabetes Care

90013009

Rev. 07/24


CONTROL N

РУ № ФСЗ
2008/01121 от


LOT



Маркировка флакона медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")», 25 тест полосок

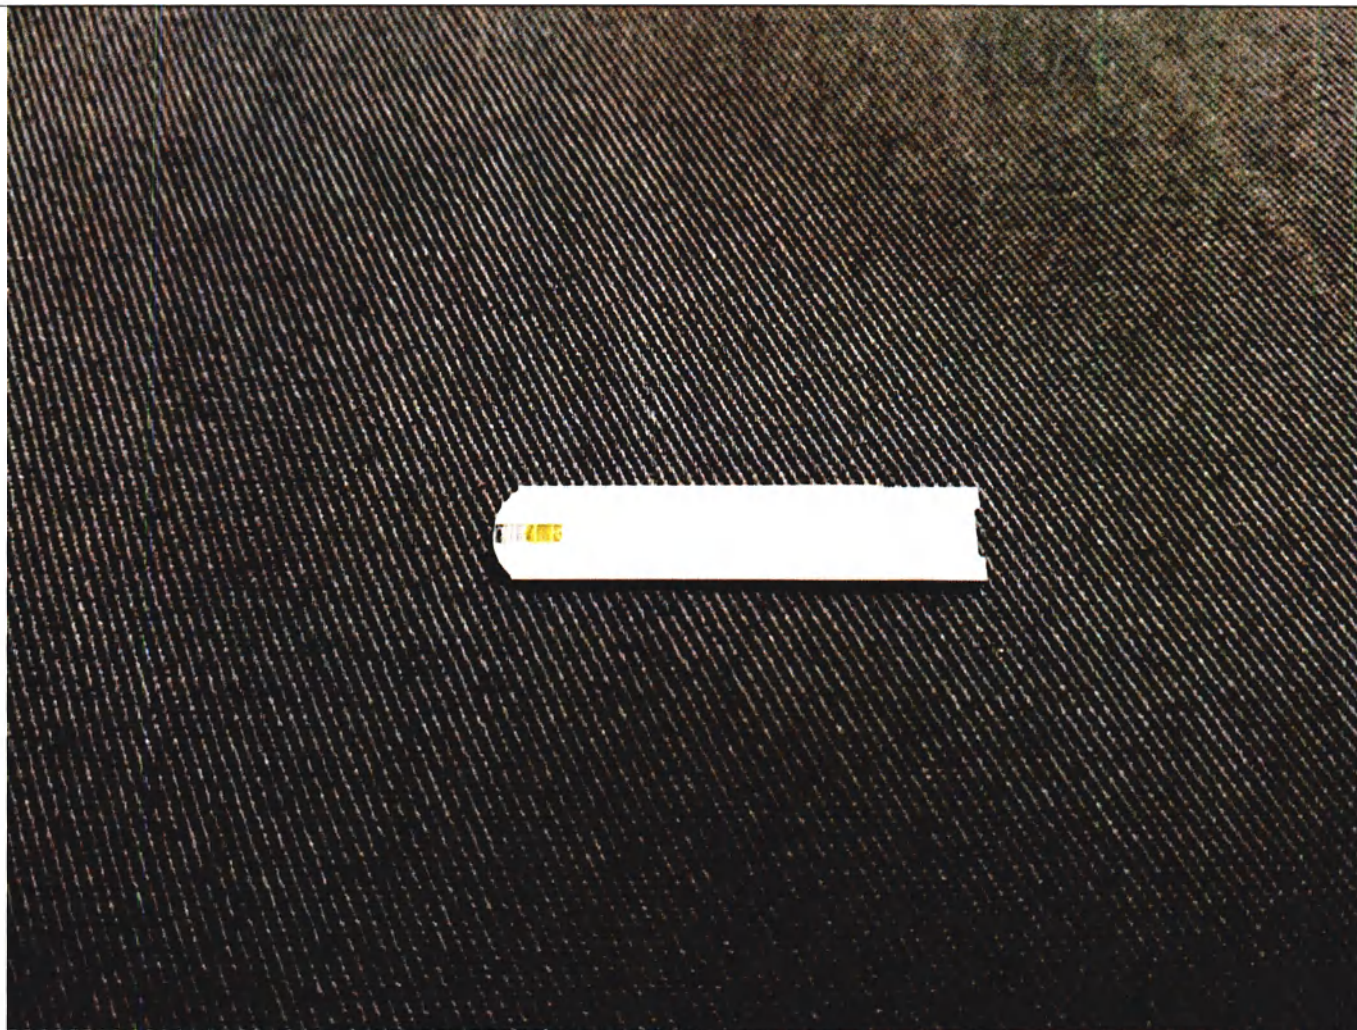


Фотографическое изображение медицинского изделия: «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»,
Варианты упаковки: 25 Тест полосок.

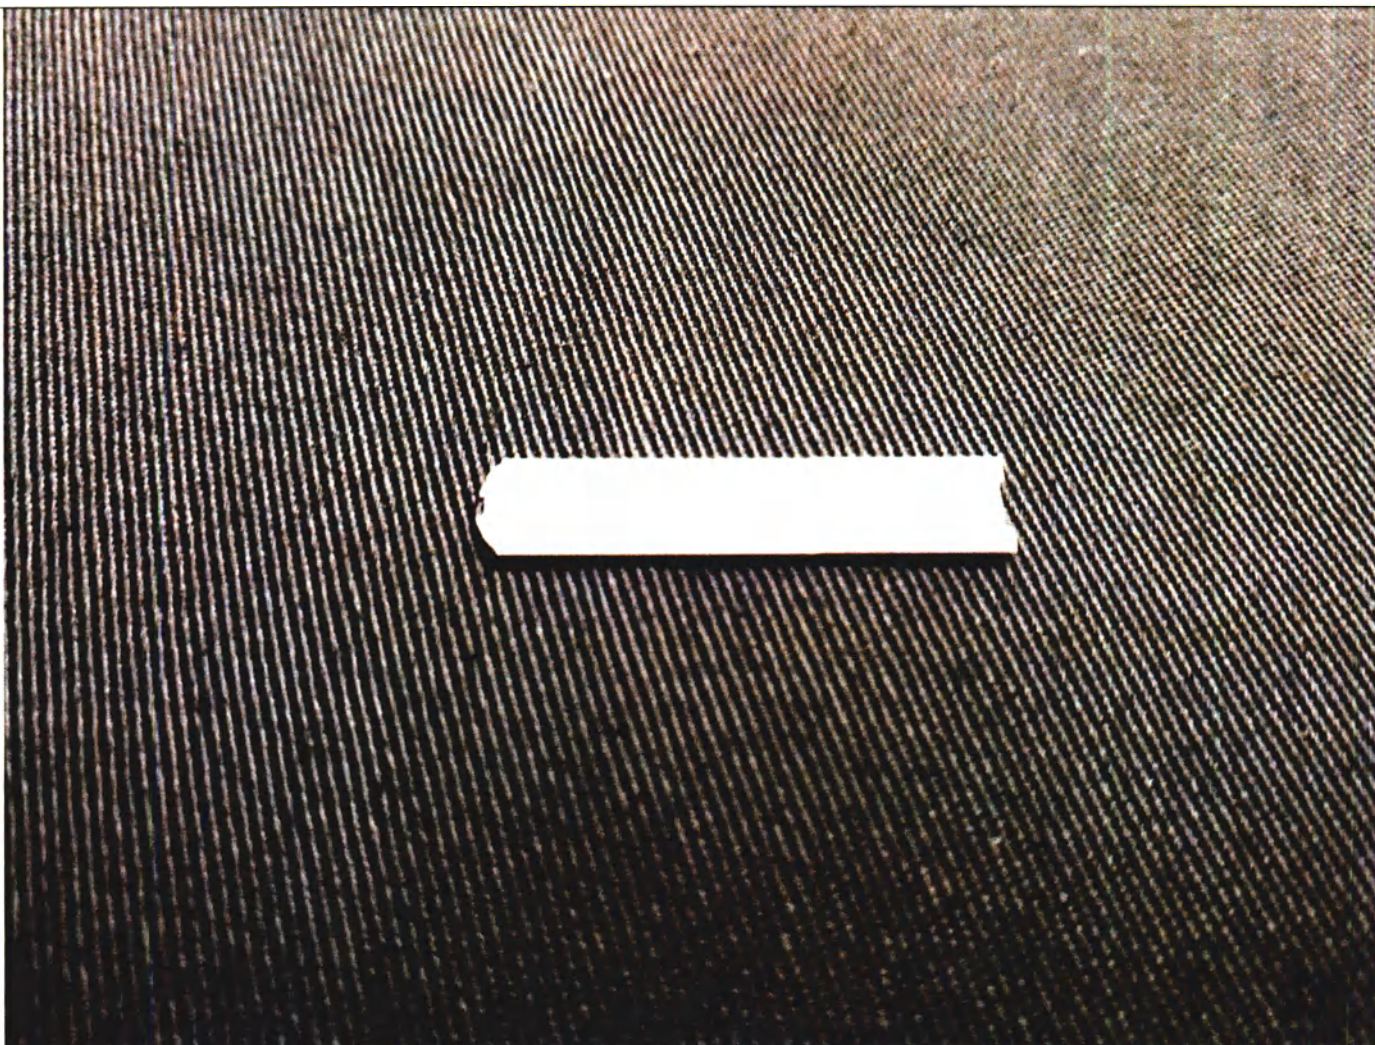

Фотографическое изображение медицинского изделия: Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")».
Варианты упаковки: 25 Тест полосок.



Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")». Варианты упаковки: 25 Тест полосок.

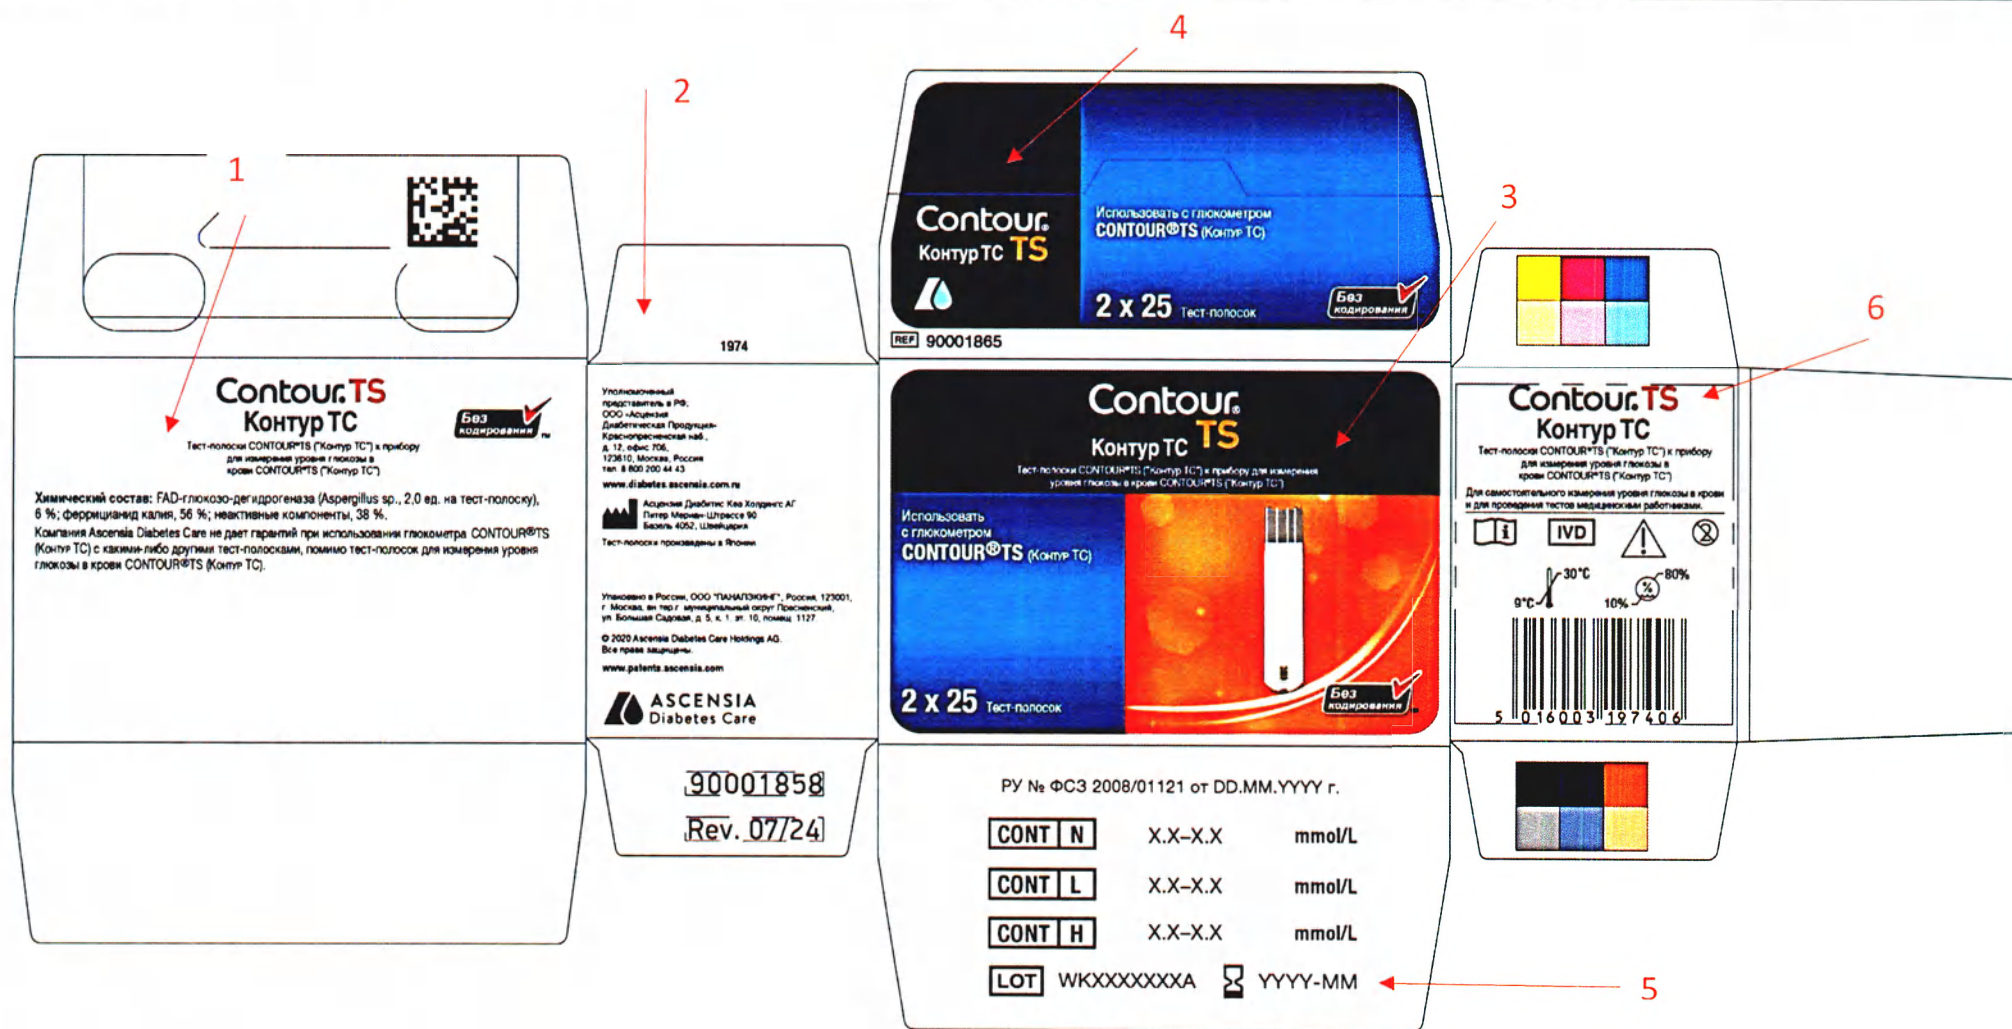


Маркировка потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2x25 тест полосок (упаковано в России)

Contour[®]TS Контур ТС

Тест-полоски CONTOUR[®]TS ("Контур ТС") к прибору
для измерения уровня глюкозы в
крови CONTOUR[®]TS ("Контур ТС")



Химический состав: FAD-глюкозо-дегидрогеназа (Aspergillus sp., 2,0 ед. на тест-полоску), 6 %; феррицианид калия, 56 %; неактивные компоненты, 38 %.

Компания Ascensia Diabetes Care не дает гарантий при использовании глюкометра CONTOUR[®]TS (Контур ТС) с какими-либо другими тест-полосками, помимо тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®]TS (Контур ТС).

Маркировка (1) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2х25 тест полосок (упаковано в России)

1974

Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «Асцензия
Диабетическая Продукция»
Краснопресненская наб.,
д. 12, офис 708,
123610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com.ru



Асцензия Диабетис Кев Холдингс АГ
Питер Мерман-Штрассе 90
Базель 4052, Швейцария

Тест-полоски произведены в Японии.

Упаковано в России, ООО «ПАНАПЭКИНГ», Россия, 123001,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
ул. Большая Садовая, д. 5, к. 1, эт. 10, помещ. 1127.

© 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Все права защищены.

www.patents.ascensia.com



ASCENSIA
Diabetes Care

90001858

Rev. 07/24

Маркировка (2) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Вариант упаковки: 2х25 тест полосок (упаковано в России)

Contour® Контур ТС TS

Тест-полоски CONTOUR®TS ("Контур ТС") к прибору для измерения
уровня глюкозы в крови CONTOUR®TS ("Контур ТС")

Использовать
с глюкометром
CONTOUR®TS (Контур ТС)

2 x 25 Тест-полосок



Без
кодирования™

Маркировка (3) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2x25 тест полосок (упаковано в России)



Маркировка (4) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Вариант упаковки: 2x25 тест полосок (упаковано в России)

РУ № ФСЗ 2008/01121 от DD.MM.YYYY г.

CONT	N	X.X-X.X	mmol/L
-------------	----------	---------	--------

CONT	L	X.X-X.X	mmol/L
-------------	----------	---------	--------

CONT	H	X.X-X.X	mmol/L
-------------	----------	---------	--------

LOT	WKXXXXXXXXA		YYYY-MM
------------	-------------	--	---------


Маркировка (5) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Вариант упаковки: 2x25 тест полосок (упаковано в России)

Contour® TS

Контур ТС

Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору
для измерения уровня глюкозы в
крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")

Для самостоятельного измерения уровня глюкозы в крови
и для проведения тестов медицинскими работниками.



Маркировка (6) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»


Вариант упаковки: 2x25 тест полосок (упаковано в России)

OVERLAP AREA

Contour[®]
Контур ТС TS
ТЕСТ-ПОЛОСКИ CONTOUR[®]TS
("КОНТУР ТС") К ПРИБОРУ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В
КРОВИ CONTOUR[®]TS ("КОНТУР ТС")

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
С ПРИБОРОМ
CONTOUR[®]TS ("КОНТУР ТС")
25 ТЕСТ-ПОЛОСОК
REF 90001865

Без
кодированияTM

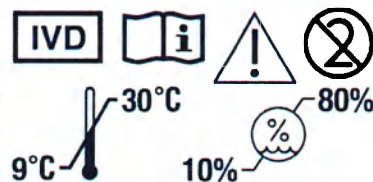

**ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ПЛОТНО
ЗАКРОЙТЕ ФЛАКОН.**

Тест-полоски произведены в Японии.
www.diabetes.ascensia.com.ru
Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «Асцензия
Диабетическая Продукция»
Краснопресненская наб.,
д. 12, офис 706,
123610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43

ASCENSIA
Diabetes Care

90013023



Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ
Питер Мериан-Штрассе 90
Базель 4052, Швейцария

LOT




CONTROL N

РУ № ФСЗ
2008/01121 от

Rev. 07/24

Маркировка флакона медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2x25 тест полосок (упаковано в России)

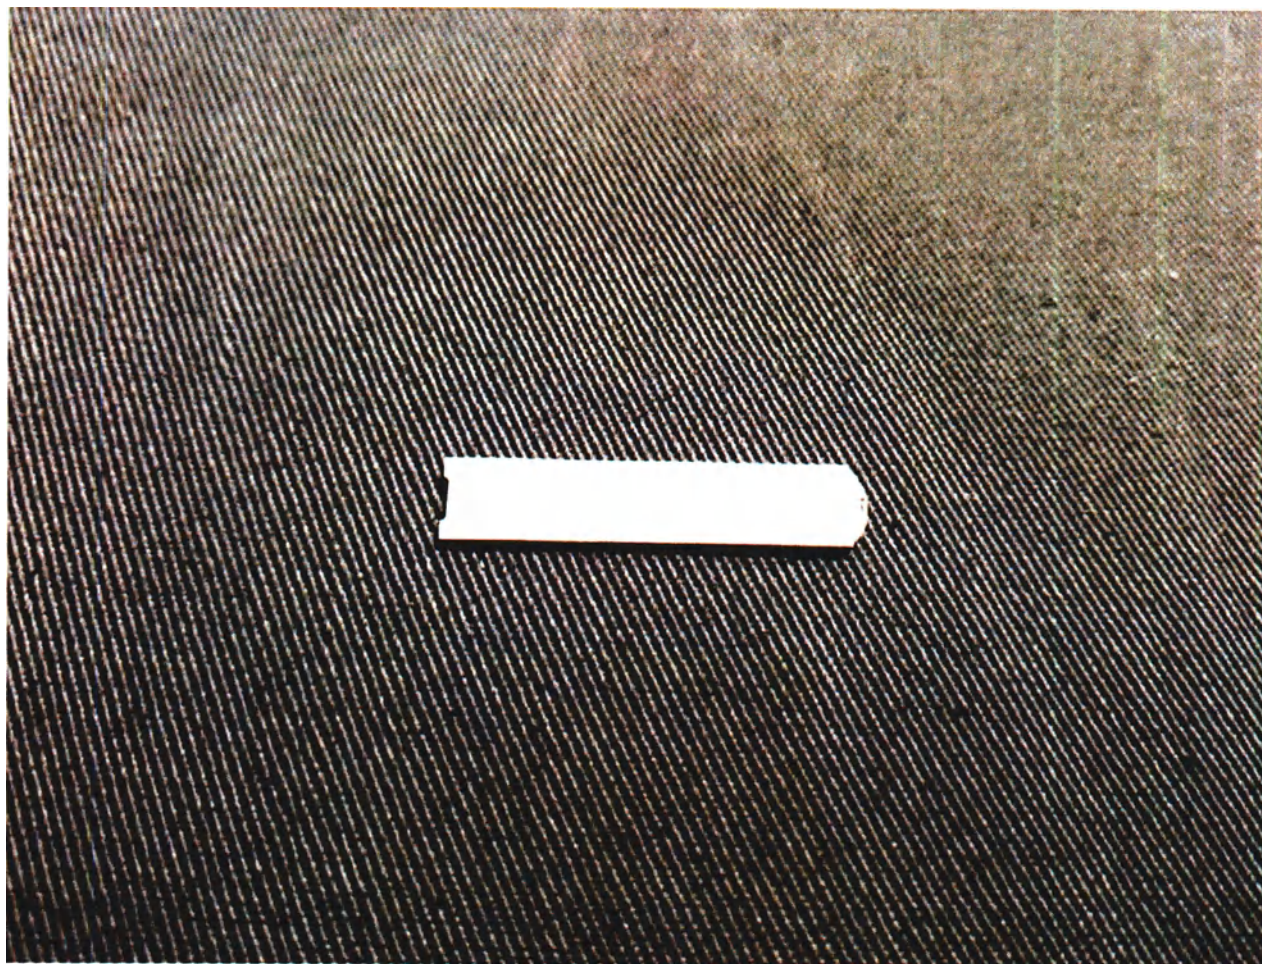


Фотографическое изображение медицинского изделия: «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Варианты упаковки: 2 x 25 Тест полосок.



Фотографические изображения медицинского изделия: «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")».
Варианты упаковки: 2 x 25 Тест полосок.

Contour[®]TS Контур ТС

Тест-полоски Contour[®]TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови Contour[®]TS ("Контур ТС")



Химический состав: FAD-глюкозо-дегидрогеназа (Aspergillus sp., 2,0 ед. на тест-полоску), 6 %; феррицианид калия, 56 %; неактивные компоненты, 38 %.

Компания Ascensia Diabetes Care не дает гарантий при использовании глюкометра CONTOUR[®]TS (Контур ТС) с какими-либо другими тест-полосками, помимо тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®]TS (Контур ТС).

Маркировка (1) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")»

Варианты упаковки: 2x50 тест полосок (упаковано в России)

1975

Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «Асценсия
Диабетическая Продукция»
Краснопресненская наб.,
д. 12, офис 706,
123610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43

www.diabetes.ascensia.com.ru



Асценсия Диабетис Кэа Холдингс АГ
Питер Мерин-Штрассе 90
Базель 4052, Швейцария

Тест-полоски произведены в Японии.

Упаковано в России, ООО «ПАНАПЭКИНГ», Россия, 123001,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
ул. Большая Садовая, д. 5, к. 1, эт. 10, помещ. 1127.

© 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Все права защищены.

www.patents.ascensia.com



ASCENSIA
Diabetes Care

90002391

Rev. 07/24

Маркировка (2) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Варианты упаковки: 2x50 тест полосок (упаковано в России)

Contour® Контур ТС TS

Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")

Использовать
с глюкометром
CONTOUR® TS (Контур ТС)

2 x 50 Тест-полосок



Без
кодирования ™

Маркировка (3) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Варианты упаковки: 2x50 тест полосок (упаковано в России)



Маркировка (4) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Варианты упаковки: 2x50 тест полосок (упаковано в России)

РУ № ФСЗ 2008/01121 от DD.MM.YYYY г.

CONT	N	X.X-X.X	mmol/L
-------------	----------	---------	--------

CONT	L	X.X-X.X	mmol/L
-------------	----------	---------	--------

CONT	H	X.X-X.X	mmol/L
-------------	----------	---------	--------

LOT	WKXXXXXXXXA		YYYY-MM
------------	-------------	---	---------

Маркировка (5) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»


Варианты упаковки: 2x50 тест полосок (упаковано в России)

Contour[®] TS

Контур ТС

Тест-полоски Contour[®] TS ("Контур ТС") к прибору
для измерения уровня глюкозы в крови
Contour[®] TS ("Контур ТС")

Для самостоятельного измерения уровня глюкозы в крови
и для проведения тестов медицинскими работниками.



5 016003 197505

Маркировка (6) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")»

Варианты упаковки: 2x50 тест полосок (упаковано в России)

OVERLAP AREA

Contour®

Контур ТС

TS


ТЕСТ-ПОЛОСКИ CONTOUR® TS
("КОНТУР ТС") К ПРИБОРУ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В
КРОВИ CONTOUR® TS ("КОНТУР ТС")

Без
кодирования™

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
С ПРИБОРОМ
CONTOUR® TS ("КОНТУР ТС")

50 ТЕСТ-ПОЛОСОК

REF 90002348

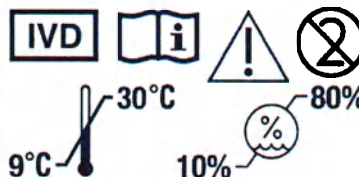

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ПЛОТНО
ЗАКРОЙТЕ ФЛАКОН.

Тест-полоски произведены в Японии.

www.diabetes.ascensia.com.ru

Уполномоченный

представитель в РФ:

ООО «Асцензия

Диабетическая Продукция»

Краснопресненская наб.,

д. 12, офис 706,

123610, Москва, Россия

тел. 8 800 200 44 43



ASCENSIA
Diabetes Care

90013025



Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ
Питер Мериан-Штрассе 90
Базель 4052, Швейцария

LOT




CONTROL N

РУ № ФСЗ
2008/01121 от


Rev. 07/24

Маркировка флакона медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Варианты упаковки: 2x50 тест полосок (упаковано в России)

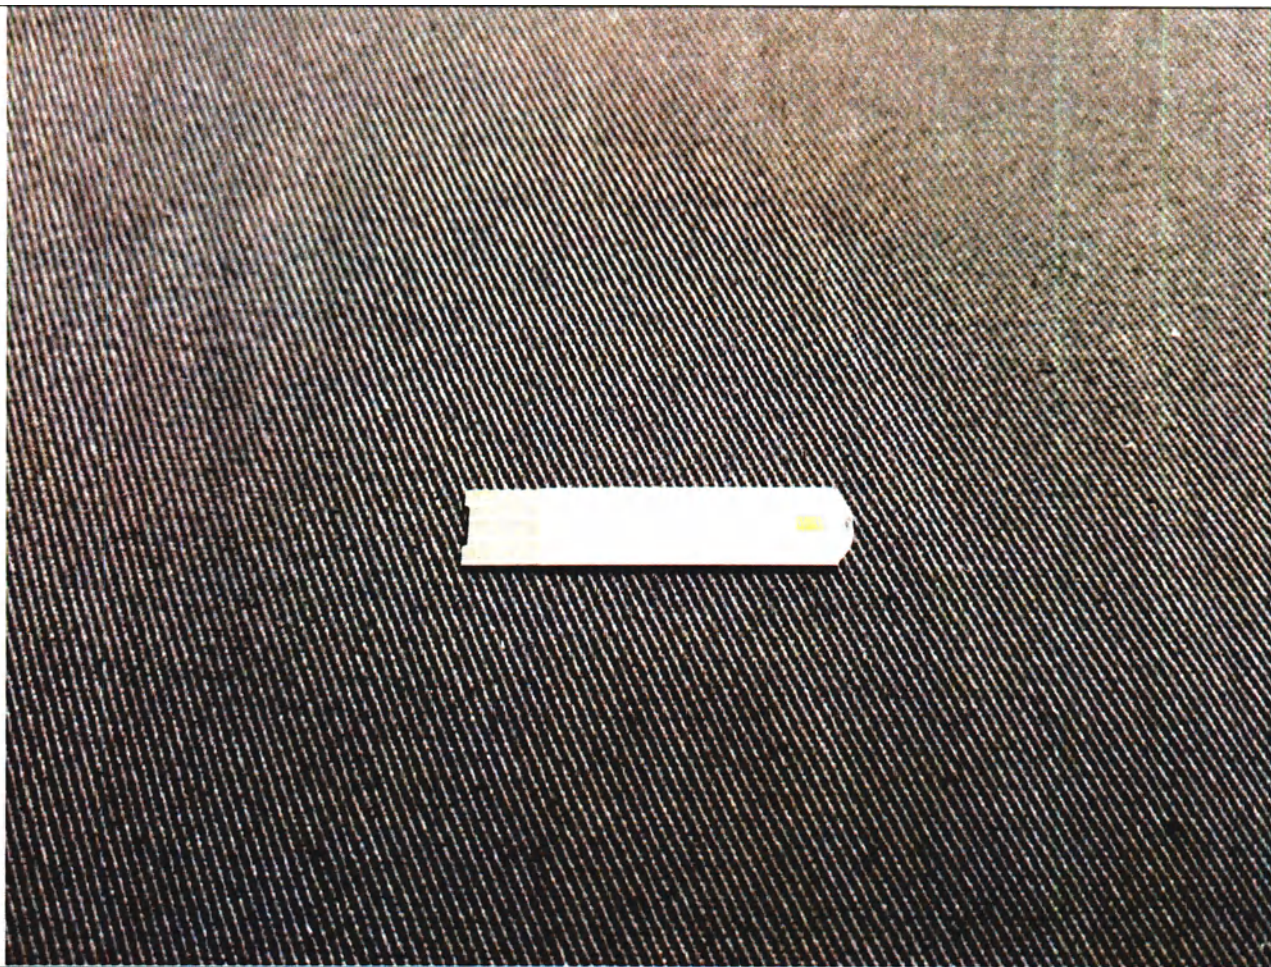

Фотографическое изображение медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Варианты упаковки: 2х50 тест полосок (упаковано в России)

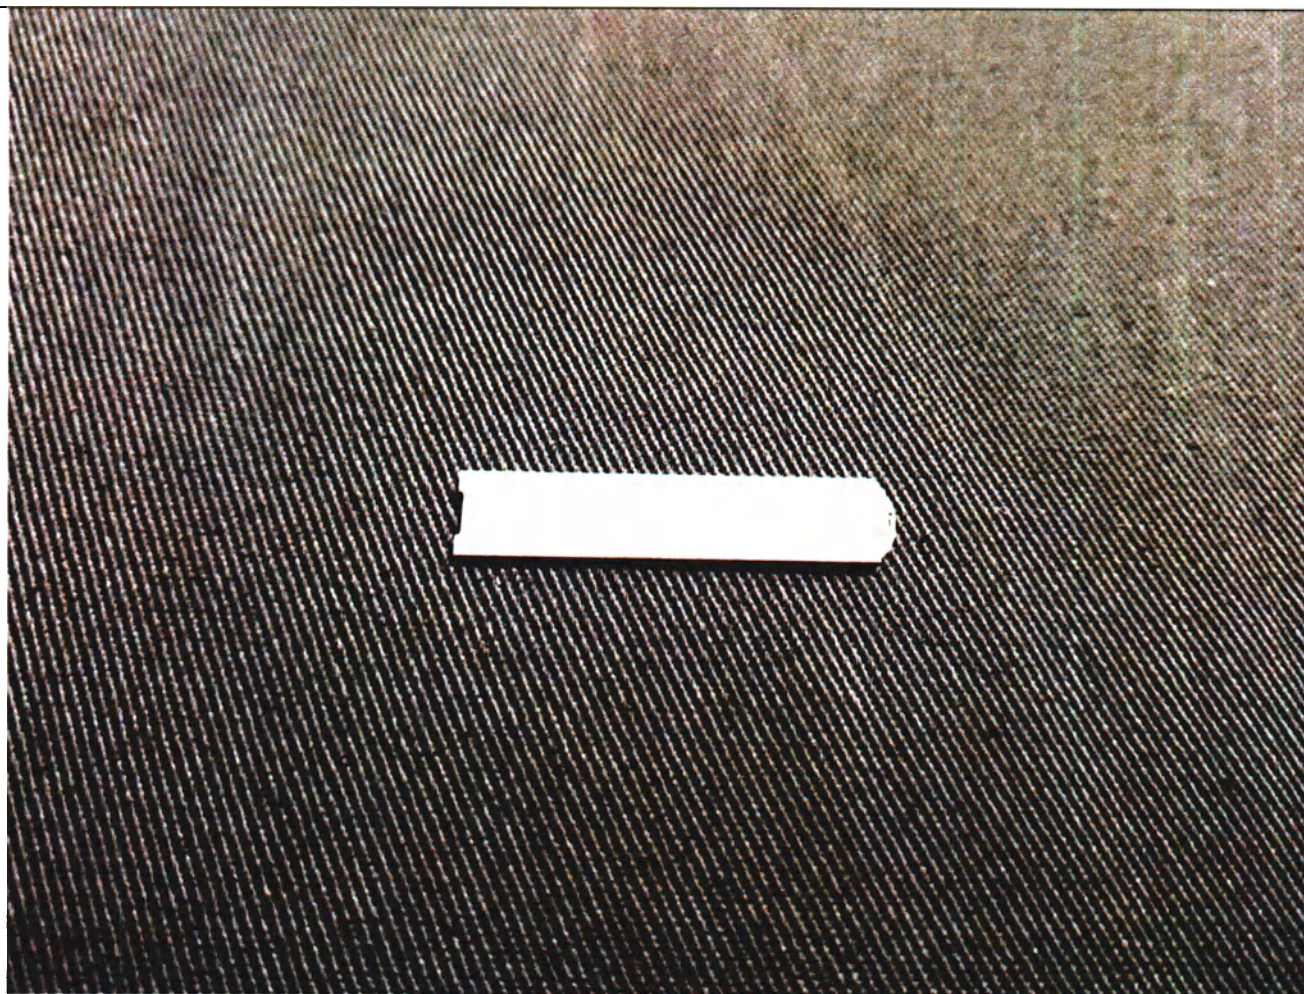

Фотографическое изображение медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Варианты упаковки: 2х50 тест полосок (упаковано в России)



Фотографические изображения медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Варианты упаковки: 2х50 тест полосок (упаковано в России)



Маркировка потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур TC") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур TC")»
 Вариант упаковки: 50 тест полосок

Contour[®] TS

Контур ТС

Тест-полоски Contour[®]TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови Contour[®]TS ("Контур ТС")

Химический состав: FAD-глюкозо-дегидрогеназа (*Aspergillus* sp., 2,0 ед. на тест-полоску), 6 %; феррицианид калия, 56 %; неактивные компоненты, 38 %.

Компания Ascensia Diabetes Care не дает гарантий при использовании глюкометра Contour[®]TS (Контур ТС) с какими-либо другими тест-полосками, помимо тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови Contour[®]TS (Контур ТС). Сведения о гарантии полностью приведены в руководстве по эксплуатации.

Маркировка (1) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 50 тест полосок

1918

Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «Асценсия»
Диабетическая продукция-
Краснопресненская наб.,
д. 12, офис 706,
123610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43

www.diabetes.ascensia.com.ru



Асценсия Диабетис Кев Холдингс АГ
Питер Мерчан-Штрассе 90
Базель 4052, Швейцария

Тест-полоски произведены в Японии.

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Все права защищены.

www.patents.ascensia.com



ASCENSIA
Diabetes Care

90008782

Rev. 07/24

Маркировка (2) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Вариант упаковки: 50 тест полосок

Contour® Контур ТС TS

Тест-полоски Contour®TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови Contour®TS ("Контур ТС")

Использовать
с глюкометром
CONTOUR®TS
(Контур ТС)

50 Тест-полосок



Без
кодирования



Маркировка (3) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 50 тест полосок



CONT N X.X-X.X mmol/L

CONT L X.X-X.X mmol/L

CONT H X.X-X.X mmol/L

LOT WKXXXXXXXXXA



YYYY-MM

ПУ № ФСЗ 2008/01121 от DD.MM.YYYY г.

Маркировка (5) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»



Вариант упаковки: 50 тест полосок

Contour[®] TS

Контур ТС

Тест-полоски Contour[®] TS ("Контур ТС") к прибору
для измерения уровня глюкозы в крови
Contour[®] TS ("Контур ТС")

Для самостоятельного измерения уровня глюкозы в крови
и для проведения тестов медицинскими работниками



Маркировка (6) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 50 тест полосок

Contour[®]
Контур ТС TS

Тест-полоски CONTOUR[®]TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®]TS ("Контур ТС")

Без кодирования 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПРИБОРОМ CONTOUR[®]TS (КОНТУР ТС)

50 ТЕСТ-ПОЛОСОК

REF 84570923

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ФЛАКОН.


Тест-полоски произведены в Японии.
www.diabetes.ascensia.com.ru

Уполномоченный представитель в РФ:
 ООО «Асцензия Диабетическая продукция»
 Краснопресненская наб., д. 12, офис 706,
 123610, Москва, Россия
 тел. 8 800 200 44 43

 **ASCENSIA**
 Diabetes Care

90013011

Rev. 07/24



Асцензия Диабетис Кеа Холдингс АГ
 Питер Мериан-Штрассе 90
 Базель 4052, Швейцария

РУ № ФСЗ
 2008/01121 от


LOT




CONTROL N

Маркировка флакона медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 50 тест полосок

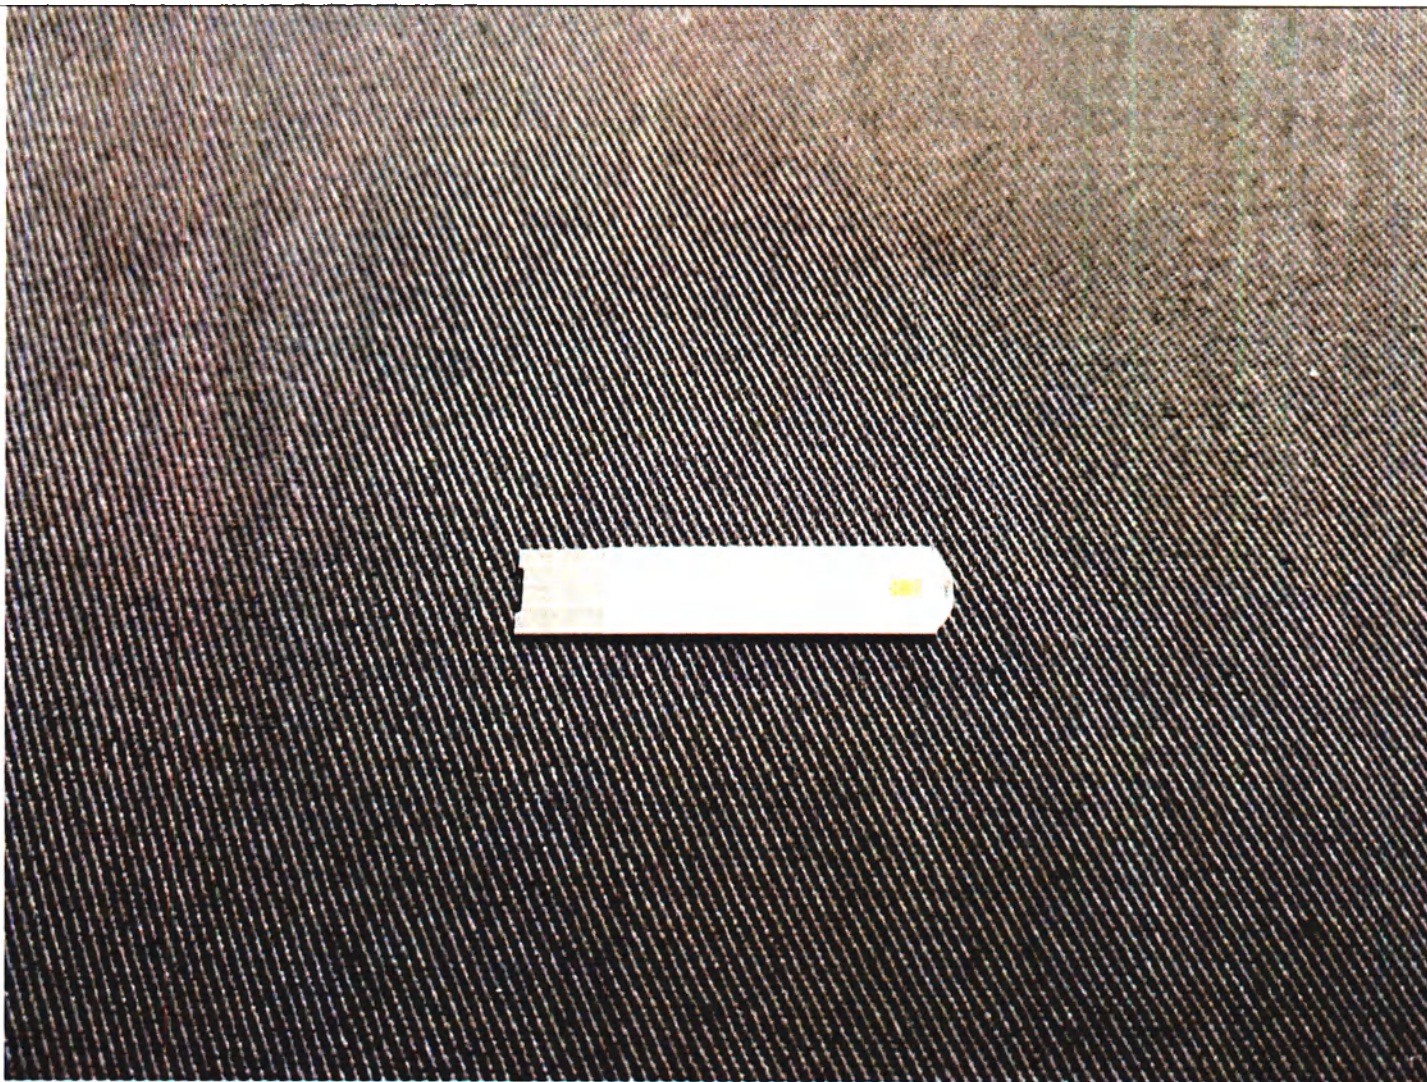

Фотографические изображения медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Вариант упаковки: 50 тест полосок

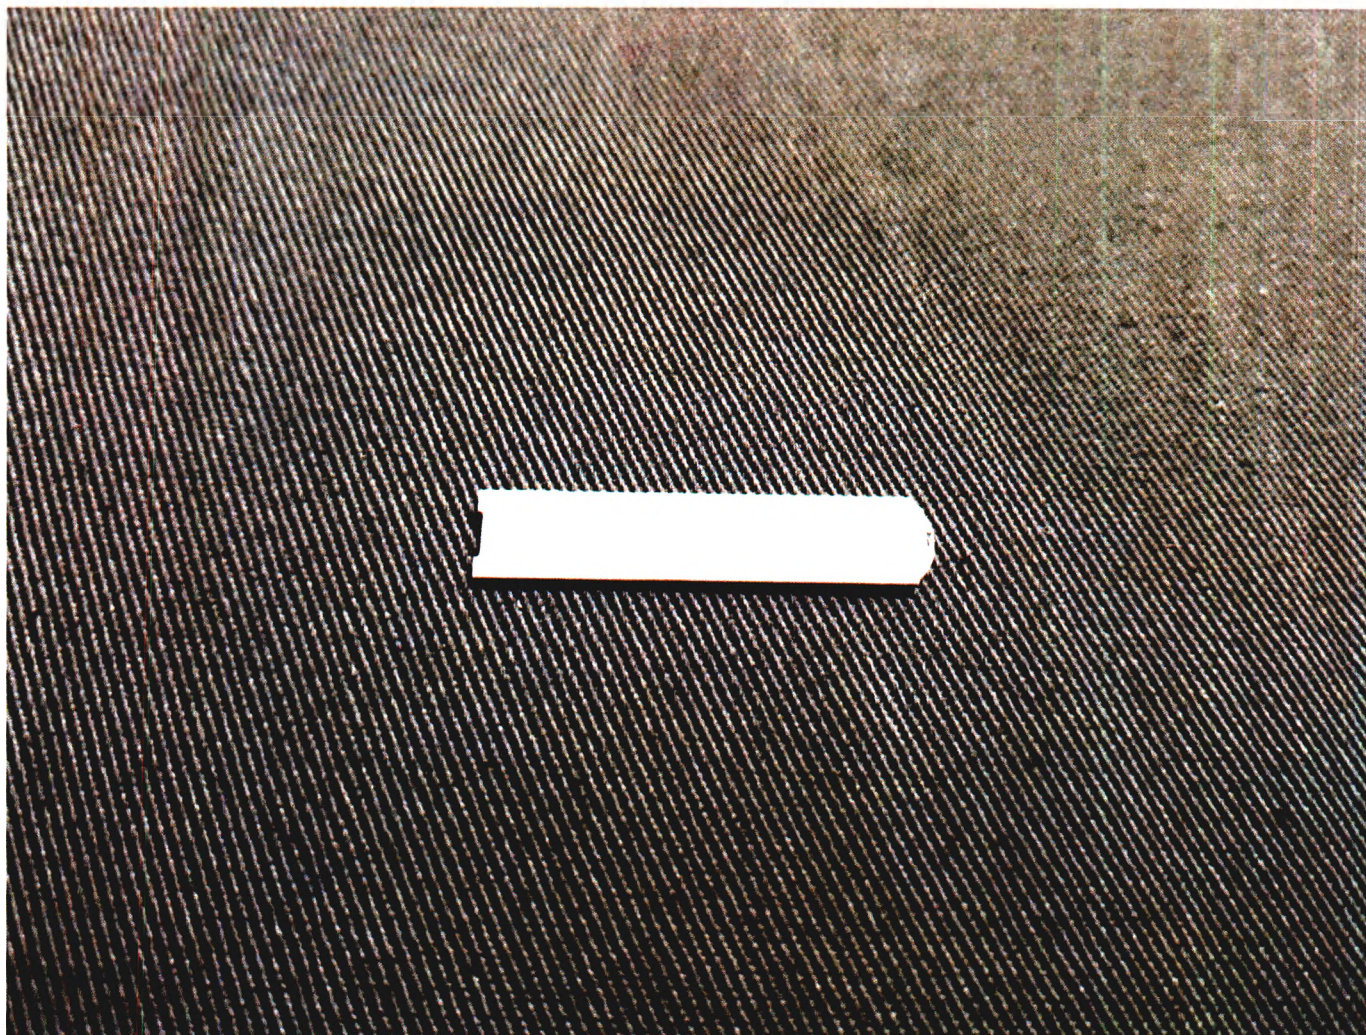


Фотографические изображения медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 50 тест полосок



Фотографические изображения медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 50 тест полосок

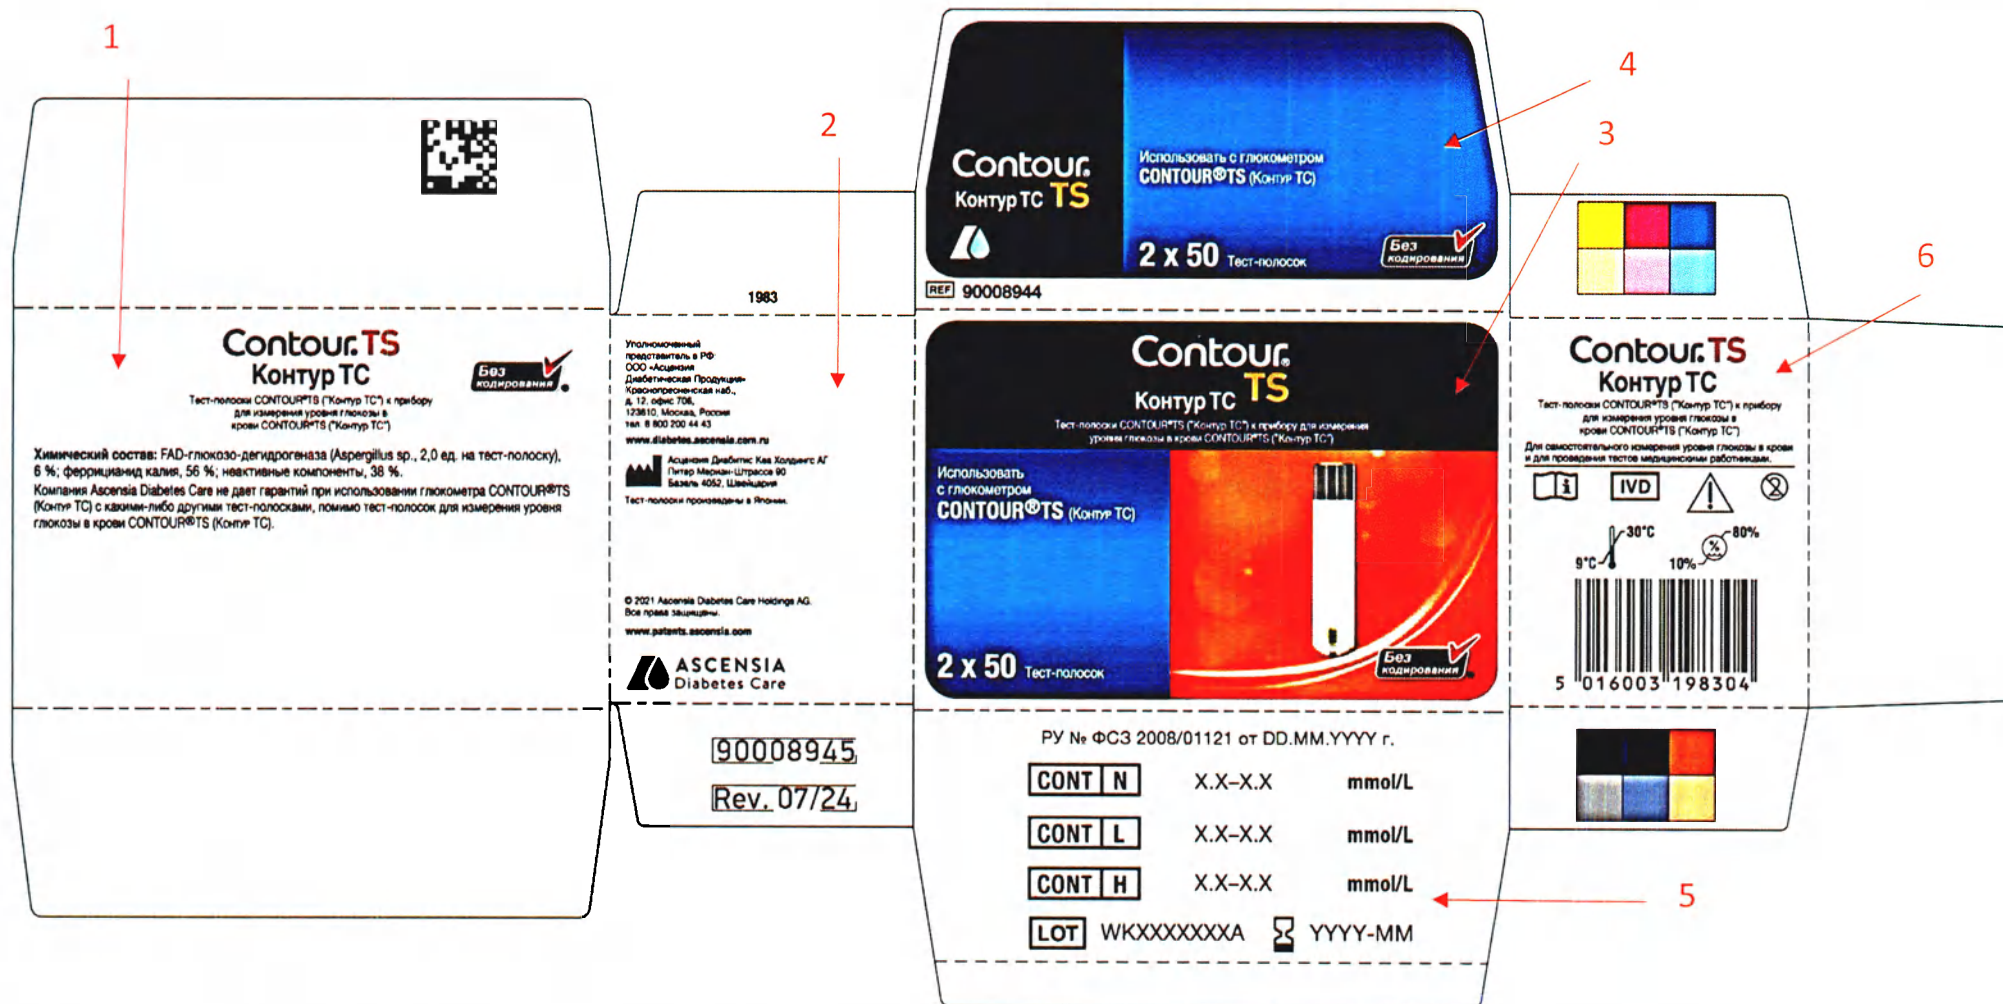


Маркировка потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2x50 тест полосок

Contour[®]TS Контур ТС

Тест-полоски CONTOUR[®]TS ("Контур ТС") к прибору
для измерения уровня глюкозы в
крови CONTOUR[®]TS ("Контур ТС")



Химический состав: FAD-глюкозо-дегидрогеназа (*Aspergillus* sp., 2,0 ед. на тест-полоску), 6 %; феррицианид калия, 56 %; неактивные компоненты, 38 %.

Компания Ascensia Diabetes Care не дает гарантий при использовании глюкометра CONTOUR[®]TS (Контур ТС) с какими-либо другими тест-полосками, помимо тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®]TS (Контур ТС).

Маркировка (1) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2х50 тест полосок

1983

Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «Асценсия
Диабетическая Продукция»
Краснопресненская наб.,
д. 12, офис 706,
123610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com.ru



Асценсия Диабетис Кев Холдингс АГ
Питер Меркман-Штрассе 90
Базель 4052, Швейцария

Тест-полоски произведены в Японии.

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Все права защищены.

www.patents.ascensia.com



ASCENSIA
Diabetes Care

90008945

Rev. 07/24

Маркировка (2) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2x50 тест полосок

Contour® Контур ТС TS

Тест-полоски CONTOUR®TS ("Контур ТС") к прибору для измерения
уровня глюкозы в крови CONTOUR®TS ("Контур ТС")

Использовать
с глюкометром
CONTOUR®TS (Контур ТС)

2 x 50 Тест-полосок



Без
кодирования®

Маркировка (3) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2x50 тест полосок



Маркировка (4) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2x50 тест полосок

РУ № ФСЗ 2008/01121 от DD.MM.YYYY г.

CONT	N	X.X-X.X	mmol/L
-------------	----------	---------	--------

CONT	L	X.X-X.X	mmol/L
-------------	----------	---------	--------

CONT	H	X.X-X.X	mmol/L
-------------	----------	---------	--------

LOT	WKXXXXXXXXXA		YYYY-MM
------------	--------------	--	---------

Маркировка (5) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Вариант упаковки: 2x50 тест полосок

Contour[®]TS

Контур ТС

Тест-полоски CONTOUR[®]TS ("Контур ТС") к прибору
для измерения уровня глюкозы в
крови CONTOUR[®]TS ("Контур ТС")

Для самостоятельного измерения уровня глюкозы в крови
и для проведения тестов медицинскими работниками.



9°C — 30°C

10% — 80%



Маркировка (6) потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR[®] TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR[®] TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2x50 тест полосок

Contour® Контур ТС TS

Тест-полоски CONTOUR®TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR®TS ("Контур ТС")

Без
кодирования 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
С ПРИБОРОМ
CONTOUR®TS (КОНТУР ТС)

50 ТЕСТ-ПОЛОСОК

REF 90008944

IVD



9°C 30°C



Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ
Питер Мериан-Штрассе 90
Базель 4052, Швейцария

10% 80%

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ПЛОТНО
ЗАКРОЙТЕ ФЛАКОН.

Тест-полоски произведены в Японии.
www.diabetes.ascensia.com.ru

Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «Асцензия
Диабетическая продукция»
Краснопресненская наб.,
д. 12, офис 706, Россия
123610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43



ASCENSIA
Diabetes Care

ПУ № ФСЗ
2008/01121 от

LOT




CONTROL N

90013027

Rev. 07/24


Маркировка флакона медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2x50 тест полосок

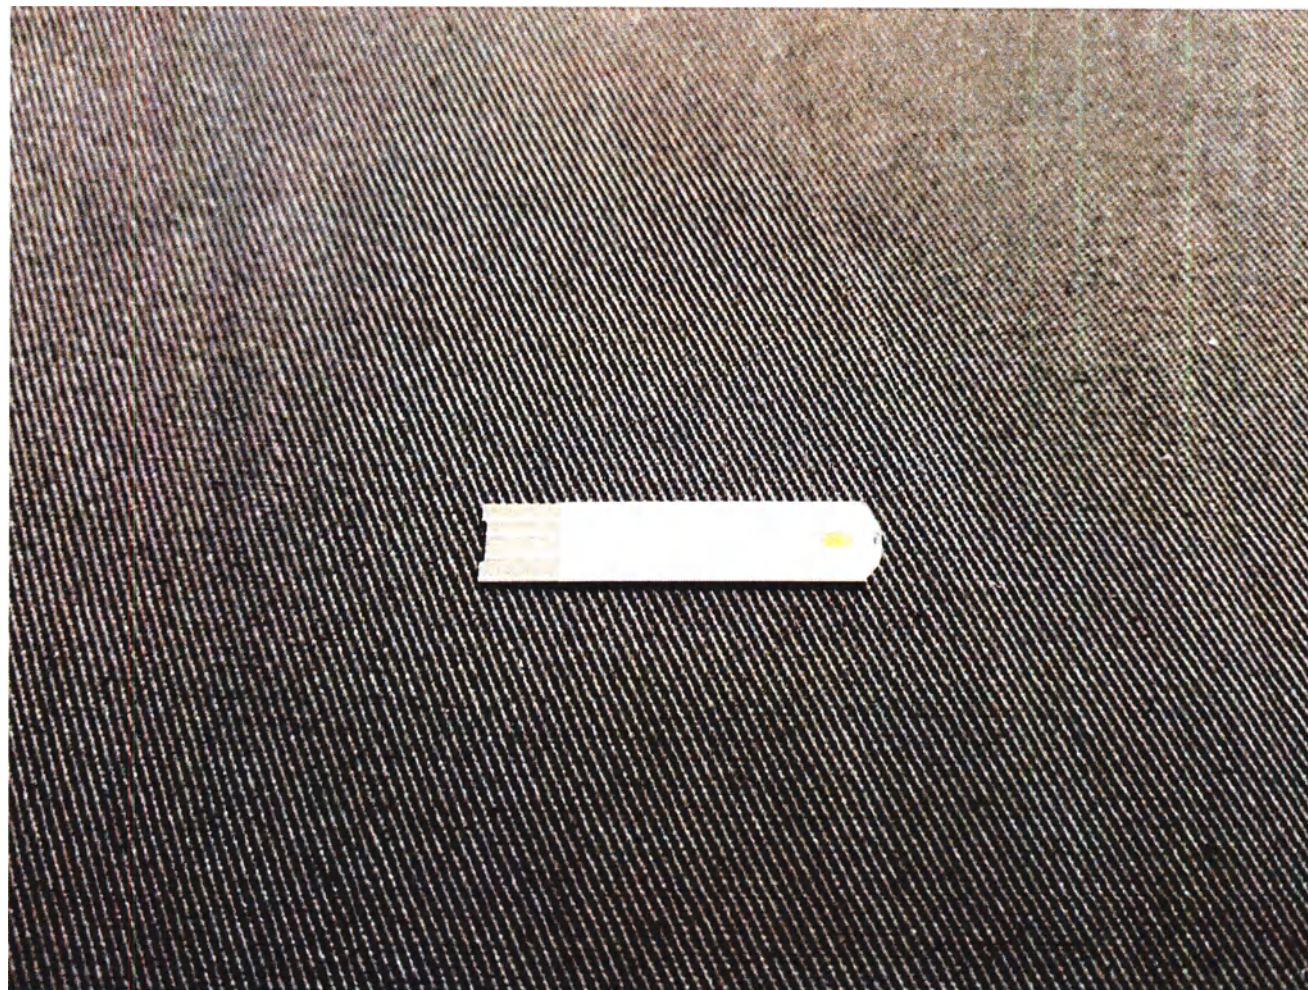

Фотографическое изображение медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2х50 тест полосок

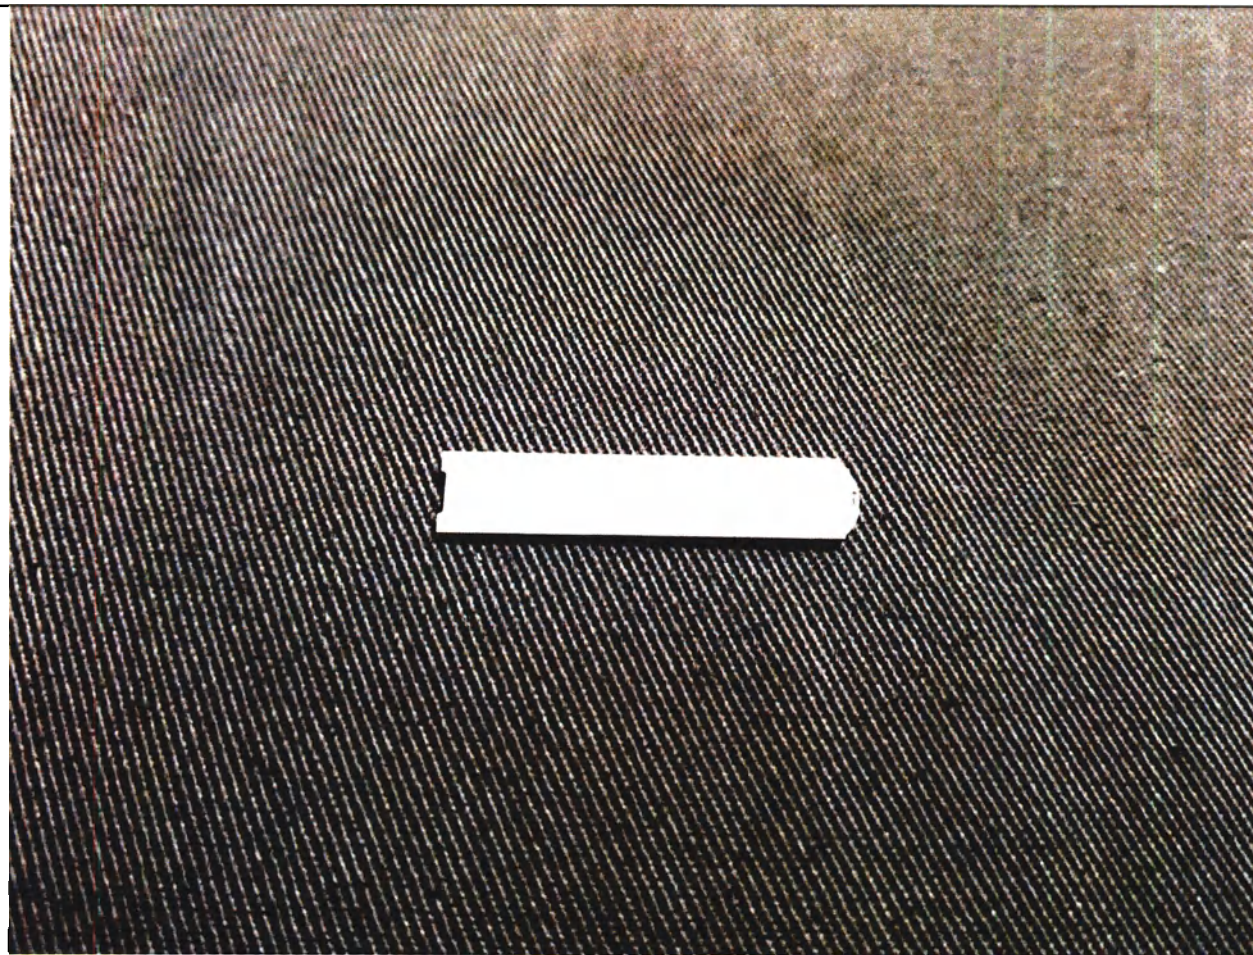

Фотографические изображения медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»

Вариант упаковки: 2х50 тест полосок



Фотографические изображения медицинского изделия «Тест-полоски CONTOUR® TS ("Контур ТС") к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR® TS ("Контур ТС")»
Вариант упаковки: 2х50 тест полосок

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью листов 55
ООО «Асцензия Диабетическая продукция»



Дата

11. 12. 2024

Doest