ОКПД2 32.50.13.190

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭНДОСФЕРА»

_____/Е.В. Реукова/

«3» июня 2024

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНДОСФЕРА»
249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново,
пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Балабаново,
2024

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1 Индивидуальная упаковка

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно STERILIZED Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX EXP XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX BN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2 Потребительская упаковка

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- **цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б – 12 штук.**

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- **цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г – 12 штук.**

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX
XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно STERILE R Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно STERILE R Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В - 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX

XX.XX.XXXX SN XXXXXXXX

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3 Транспортная упаковка

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX LOT XXXXXXXX SN XXXXXXXX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено 154 листов
ООО «ЭНДОСФЕРА»
Генеральный директор
_____ / Е.В. Реукова
« 30 » августа 2024 г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ОКПД2 32.50.13.190

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭНДОСФЕРА»

_____ / Е.В. Реукова /

« 3 » июня 2024

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНДОСФЕРА»
249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново,
пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Балабаново,
2024

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

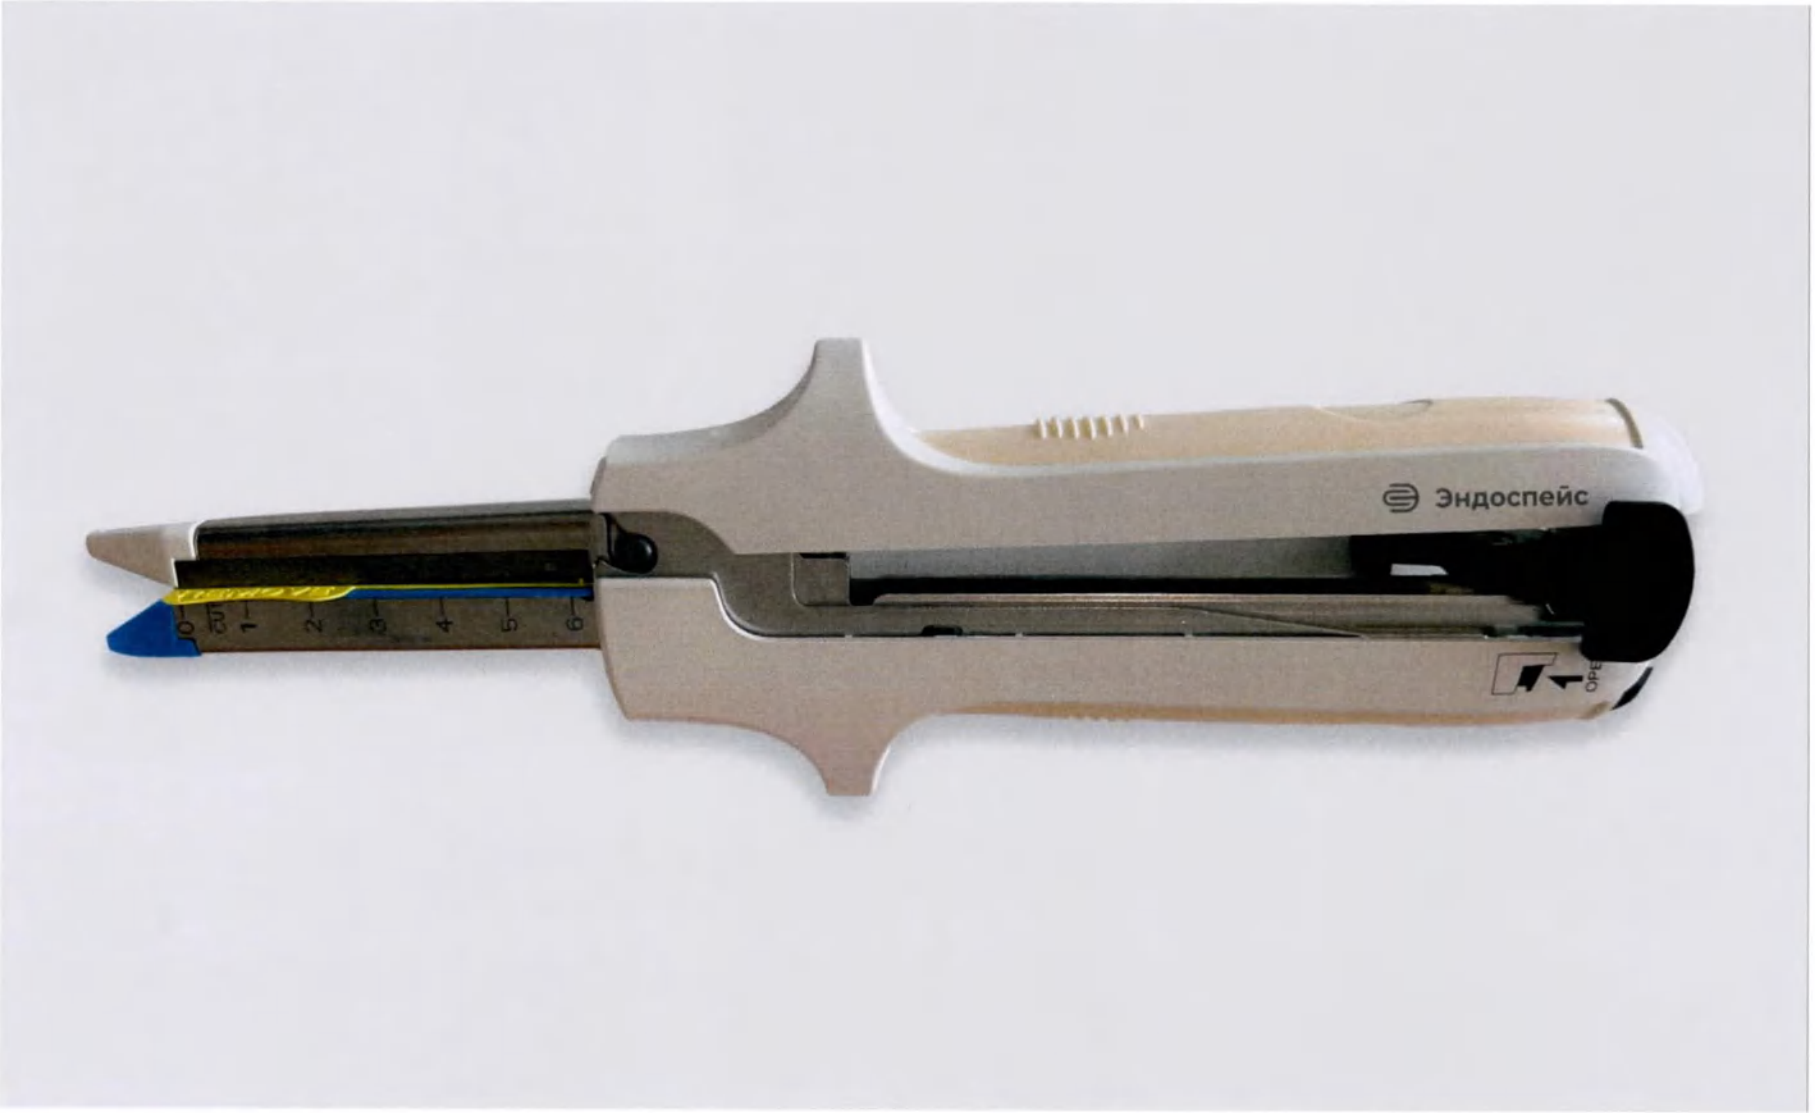

Рисунок 1 – Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 2 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

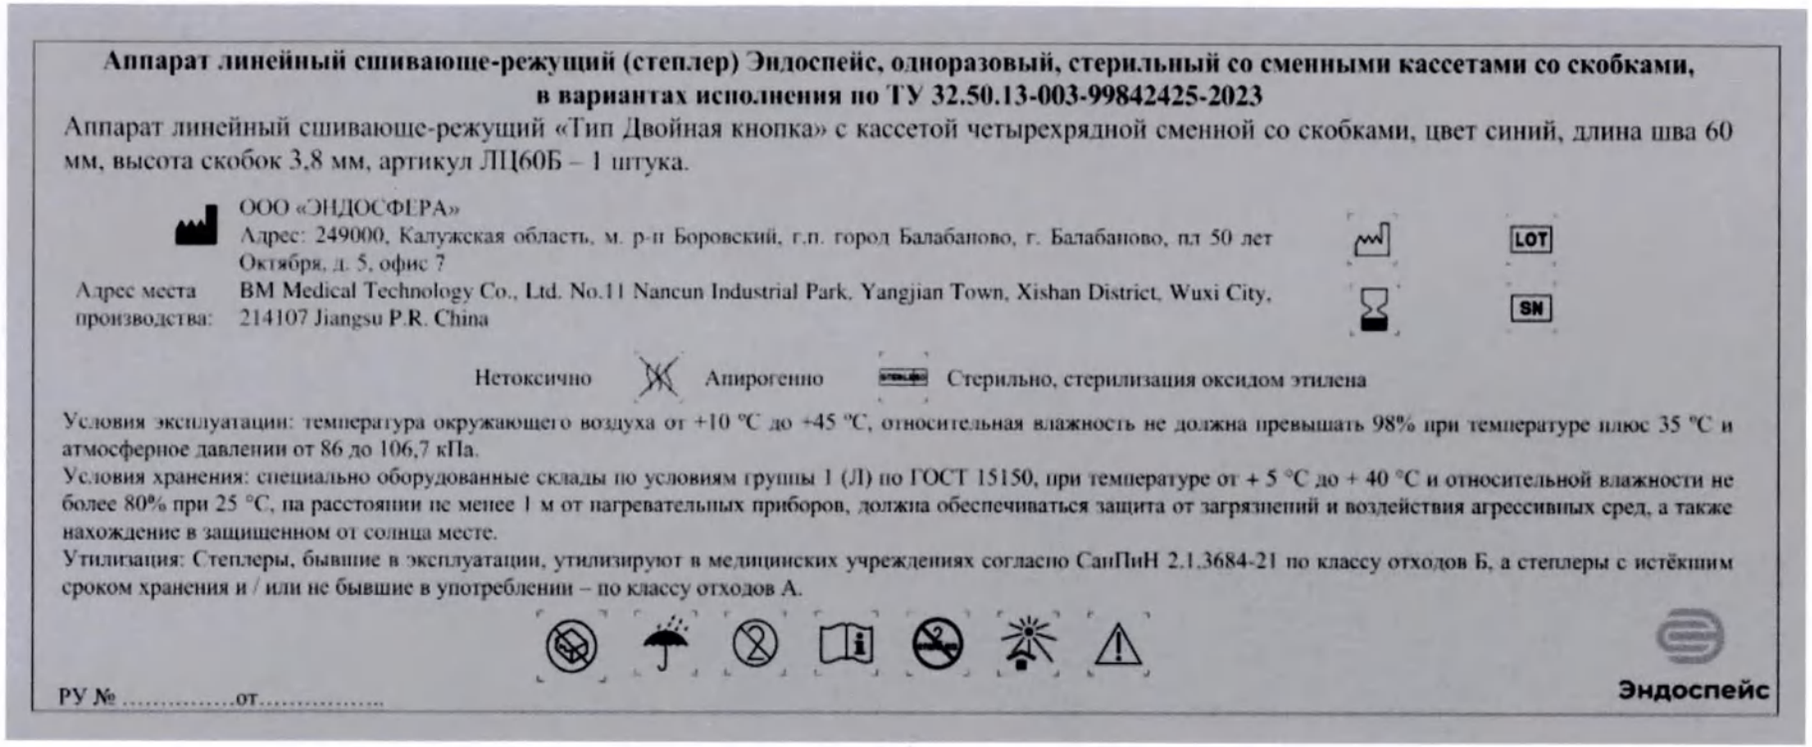

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 2А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

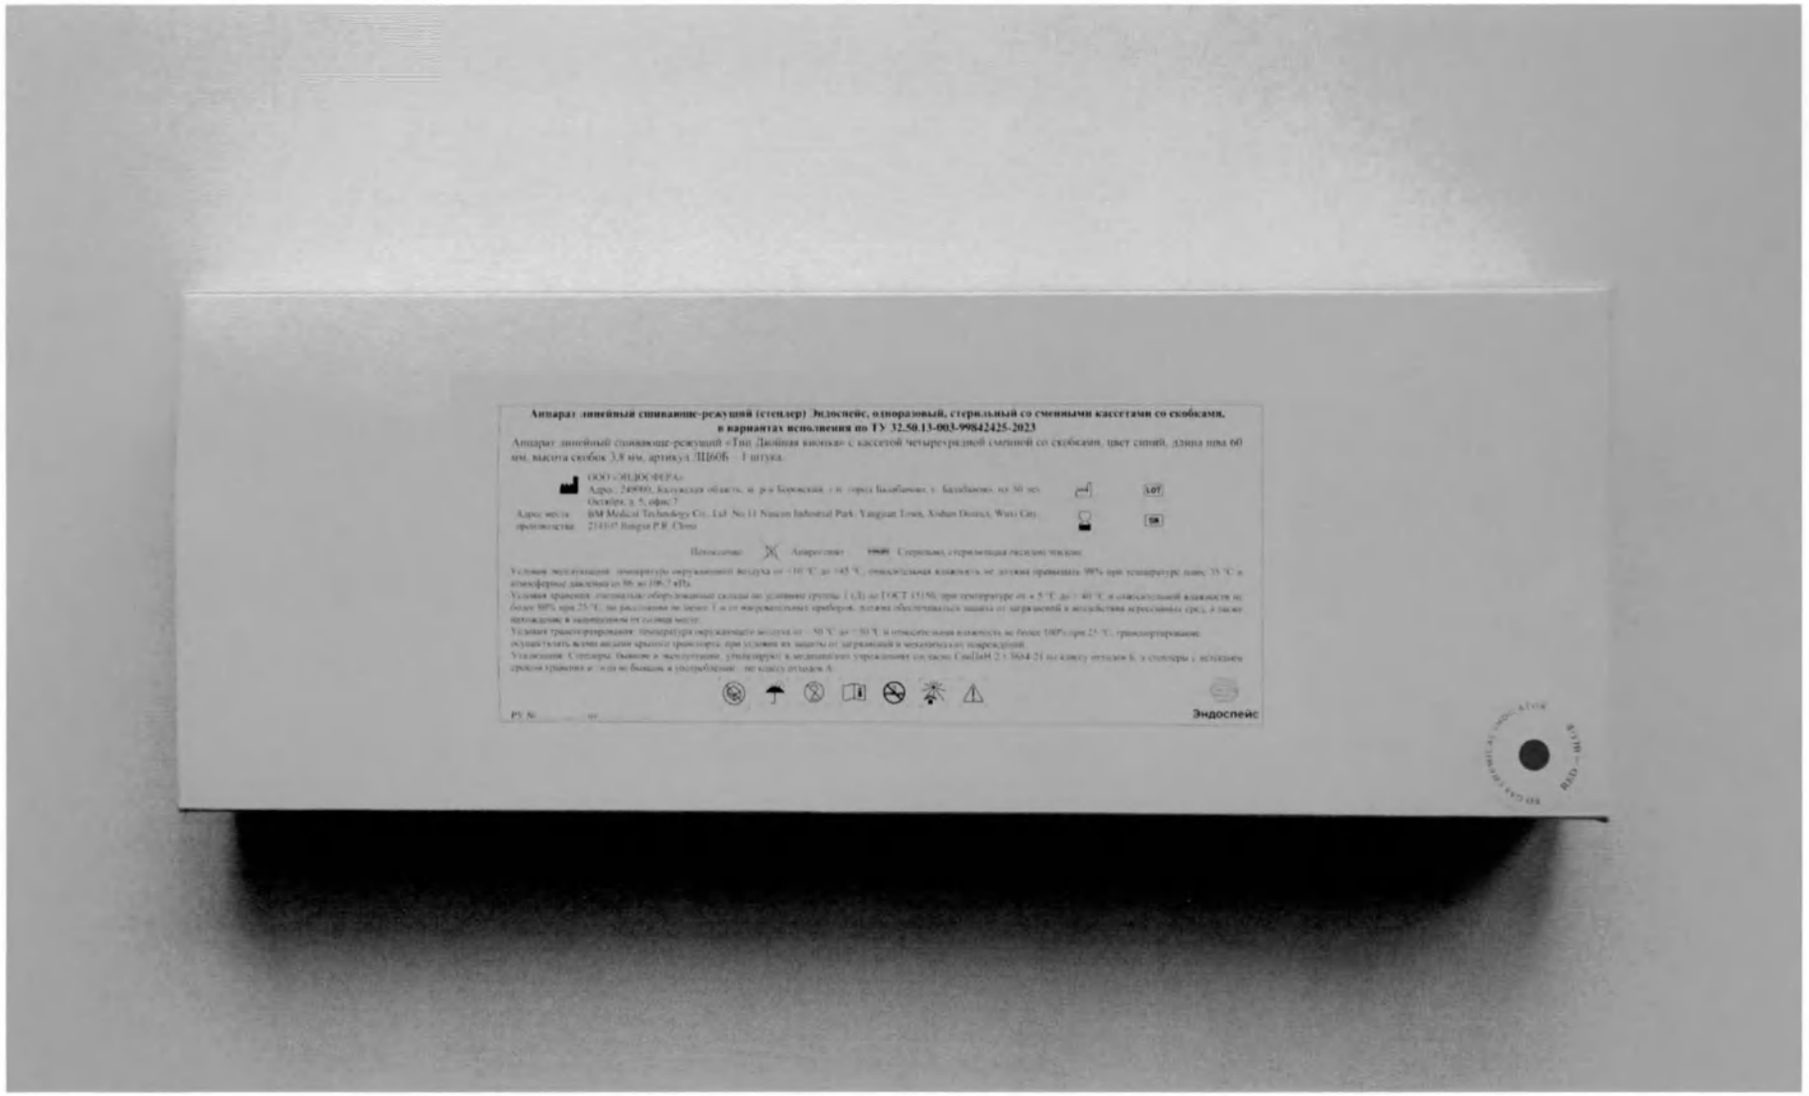

Рисунок 3 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

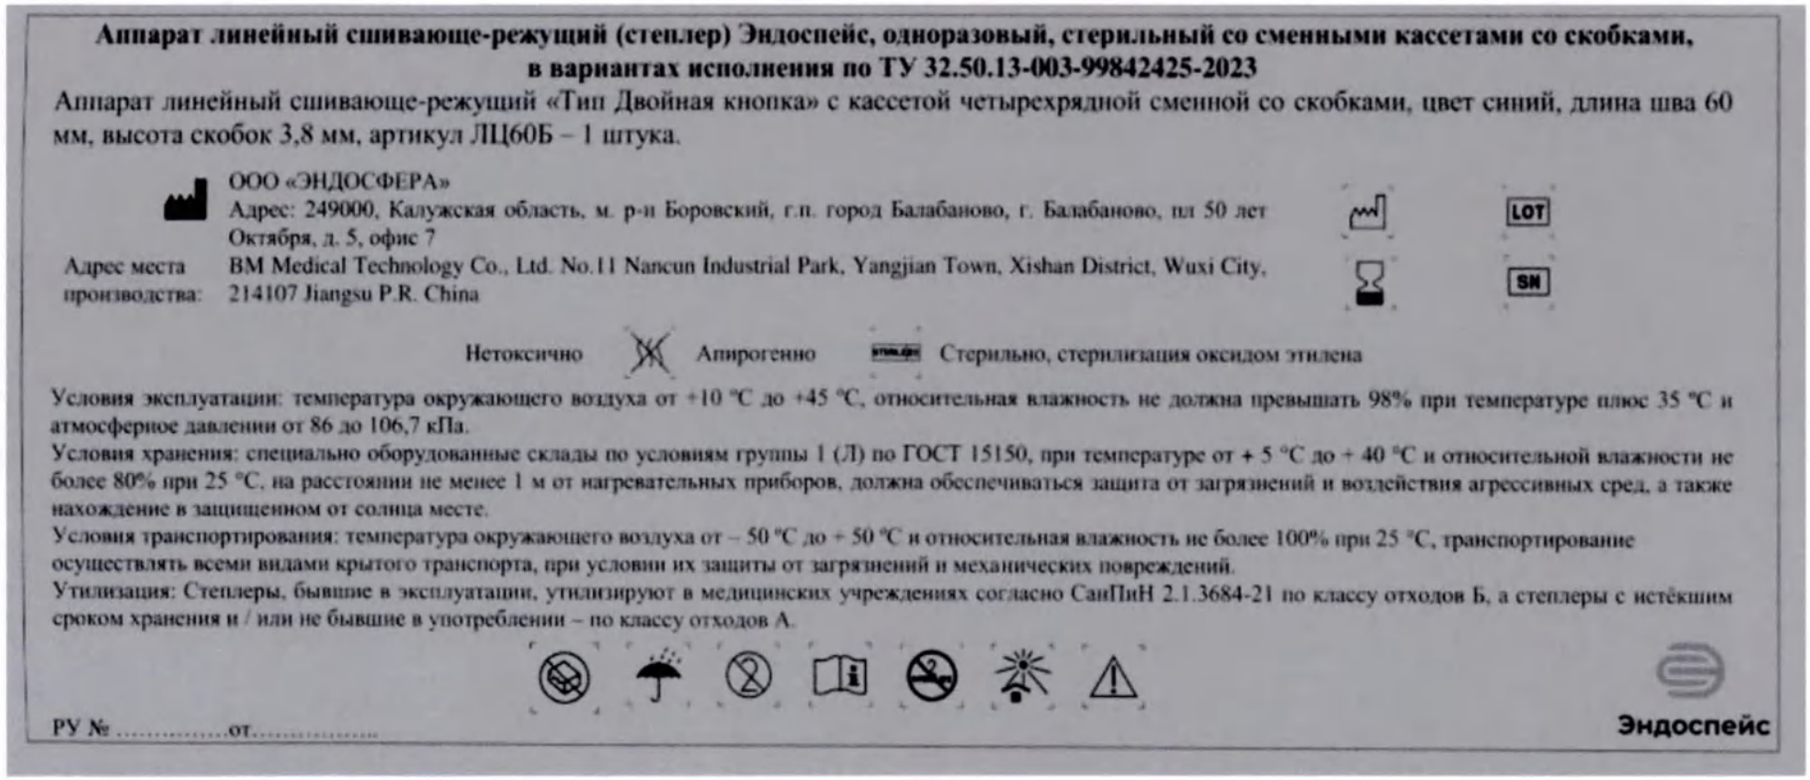

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 3А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 4 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

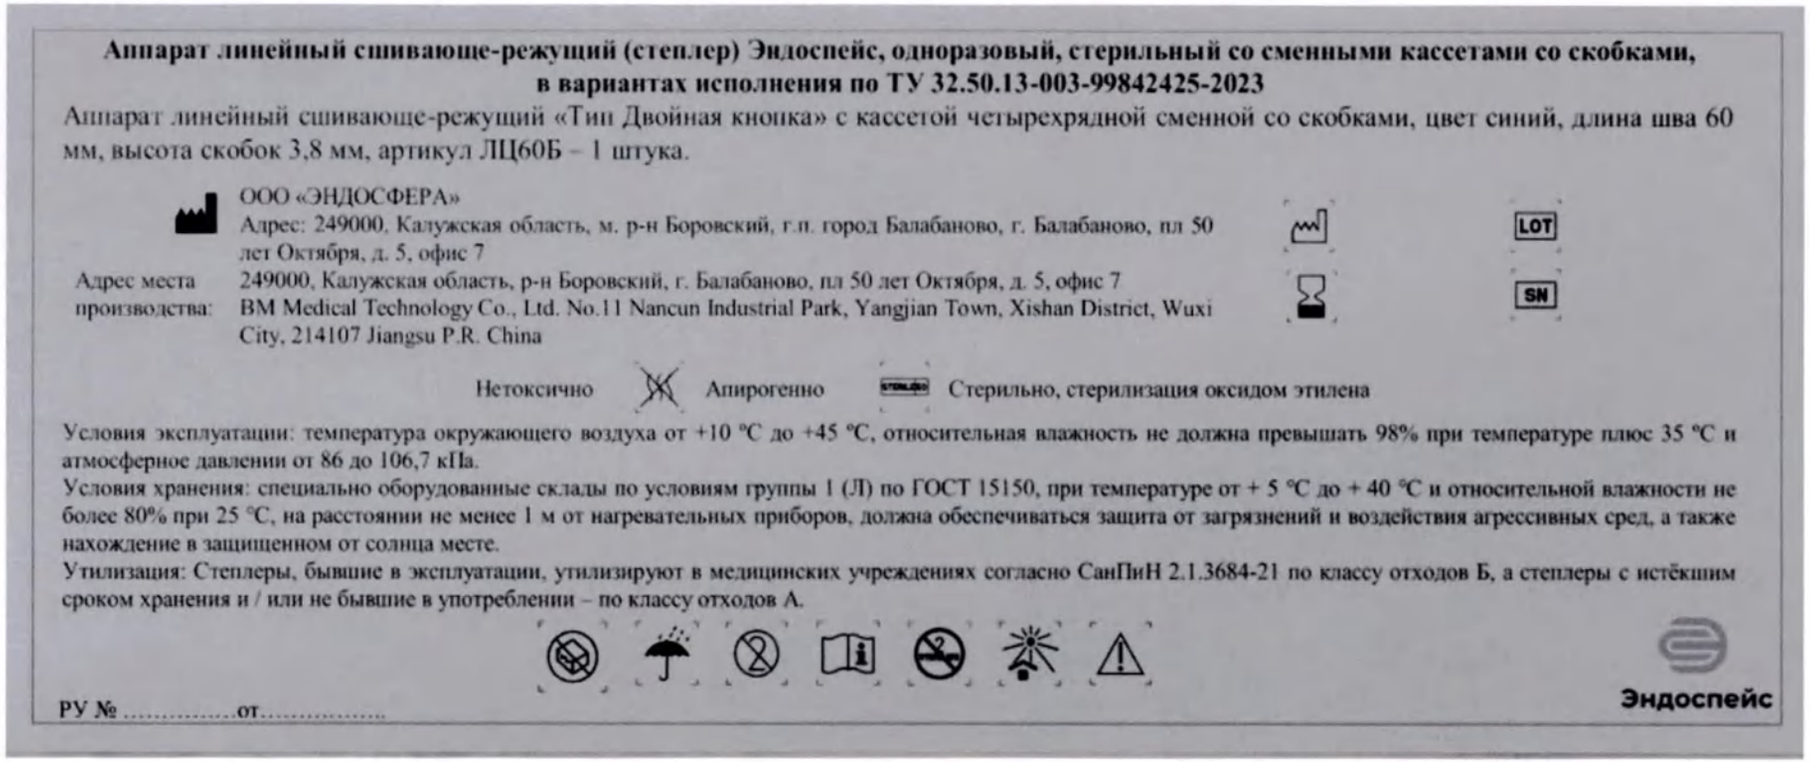

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 4А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

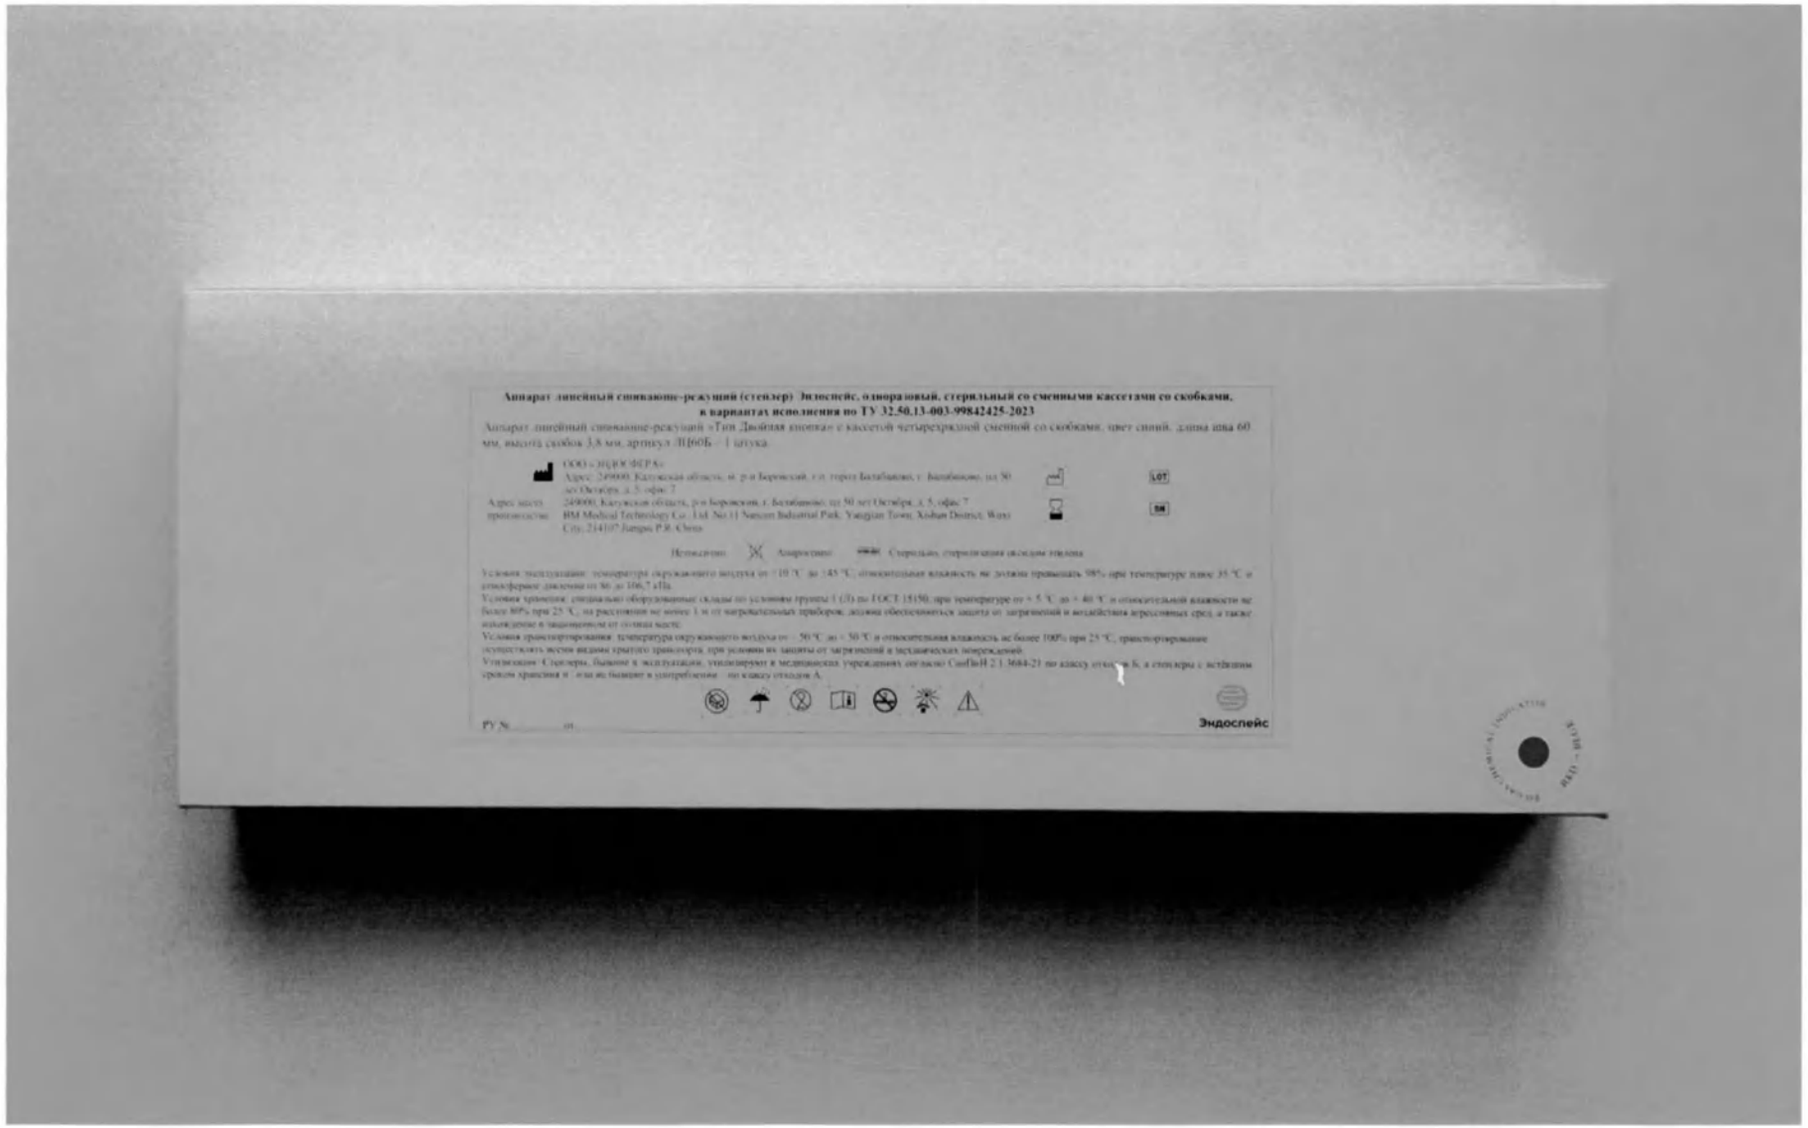

Рисунок 5 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

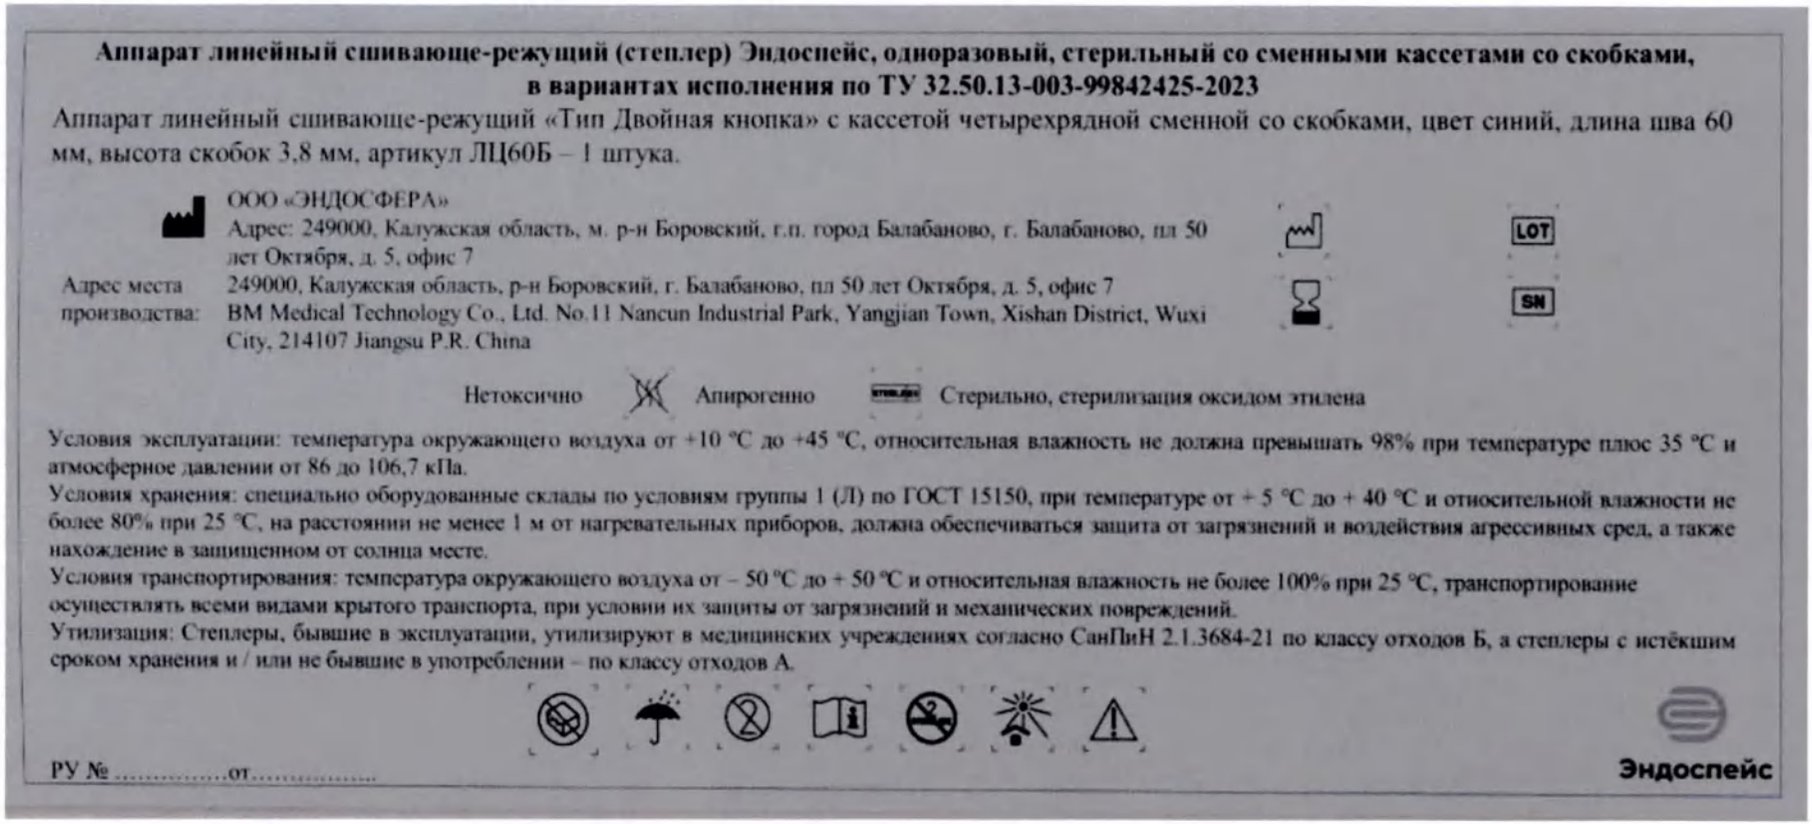

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 5А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

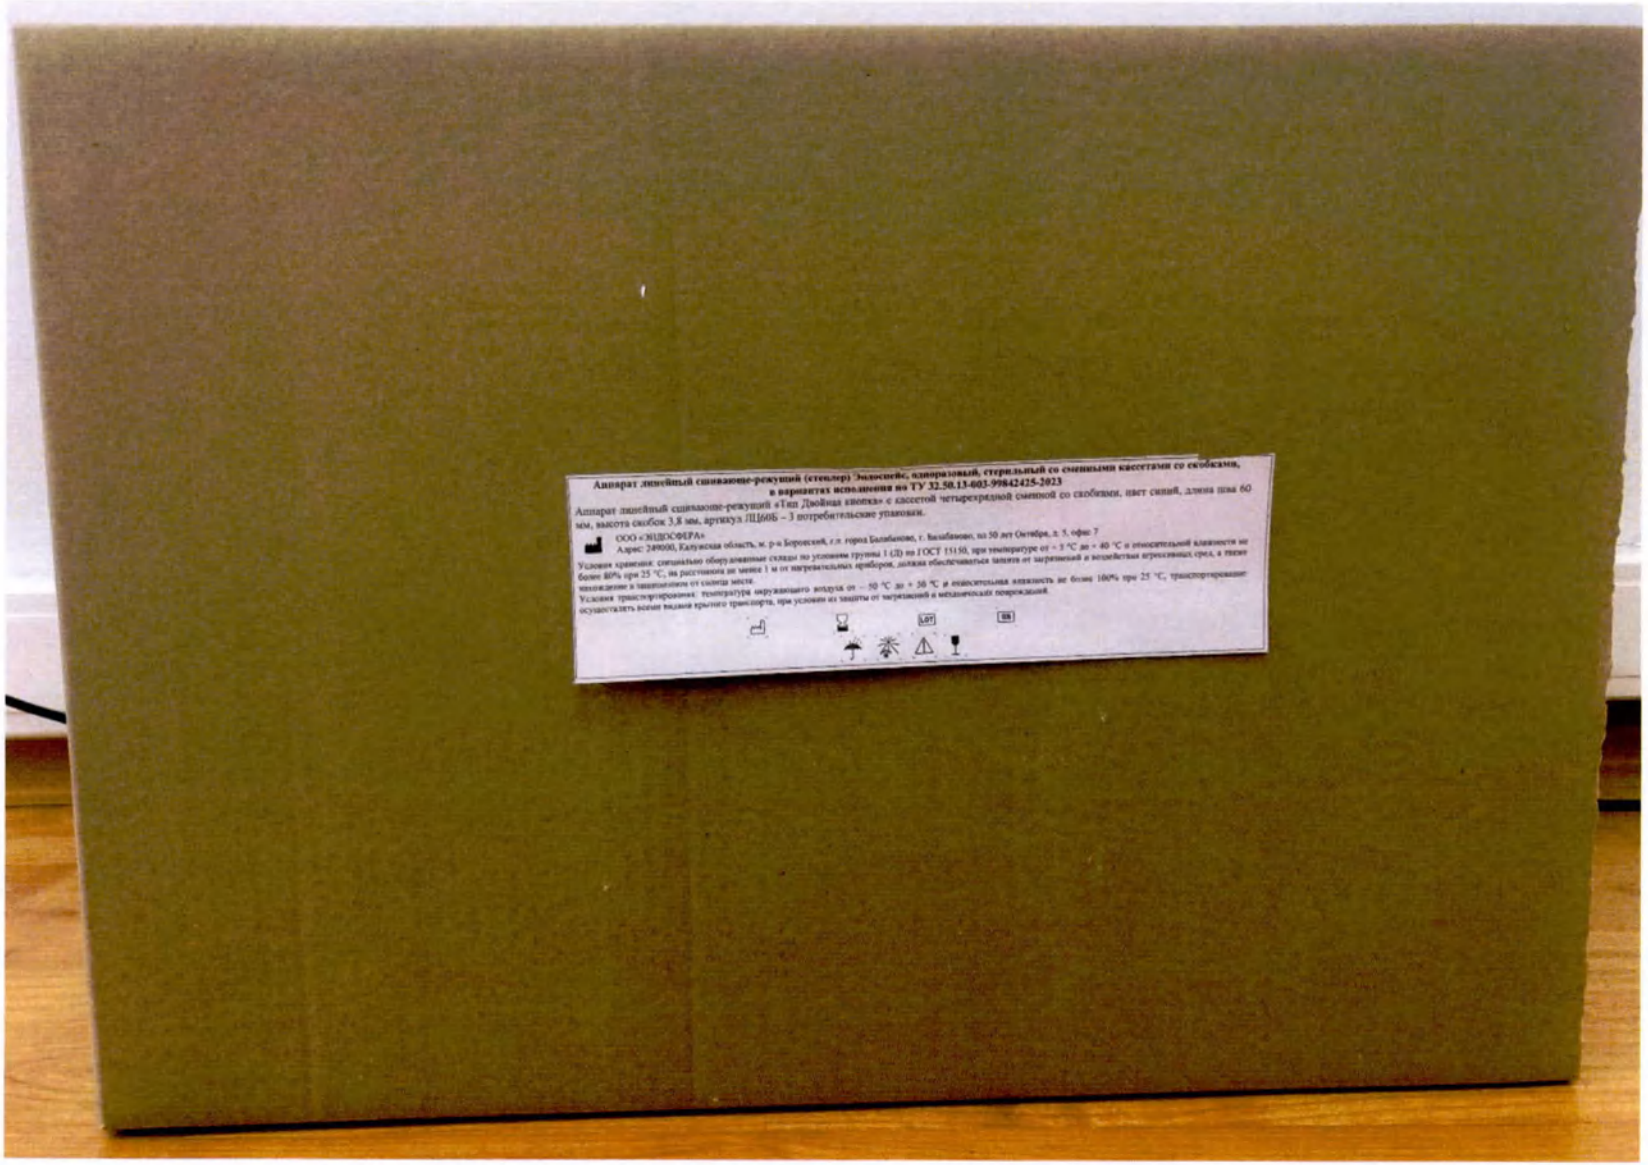

Рисунок 6 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

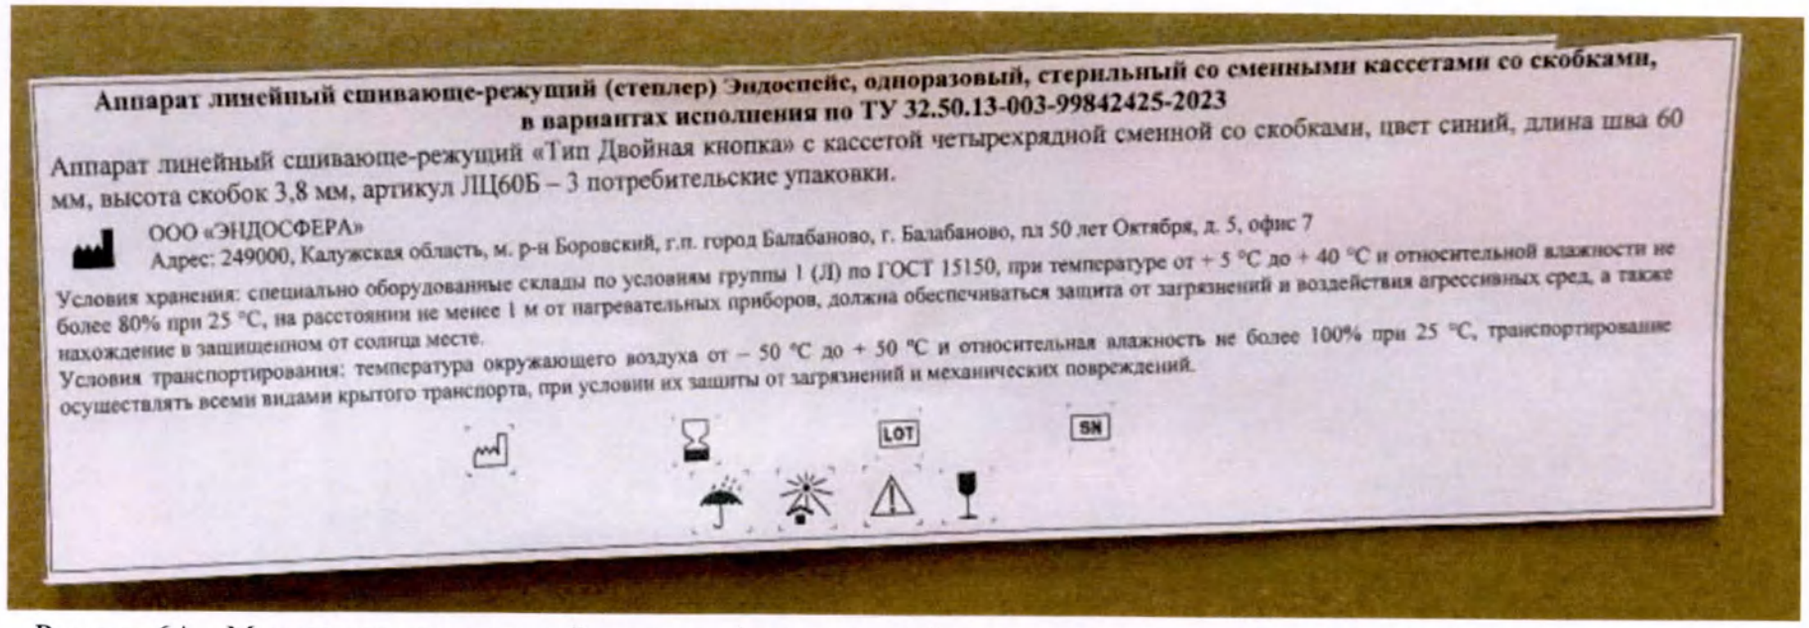

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 6А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

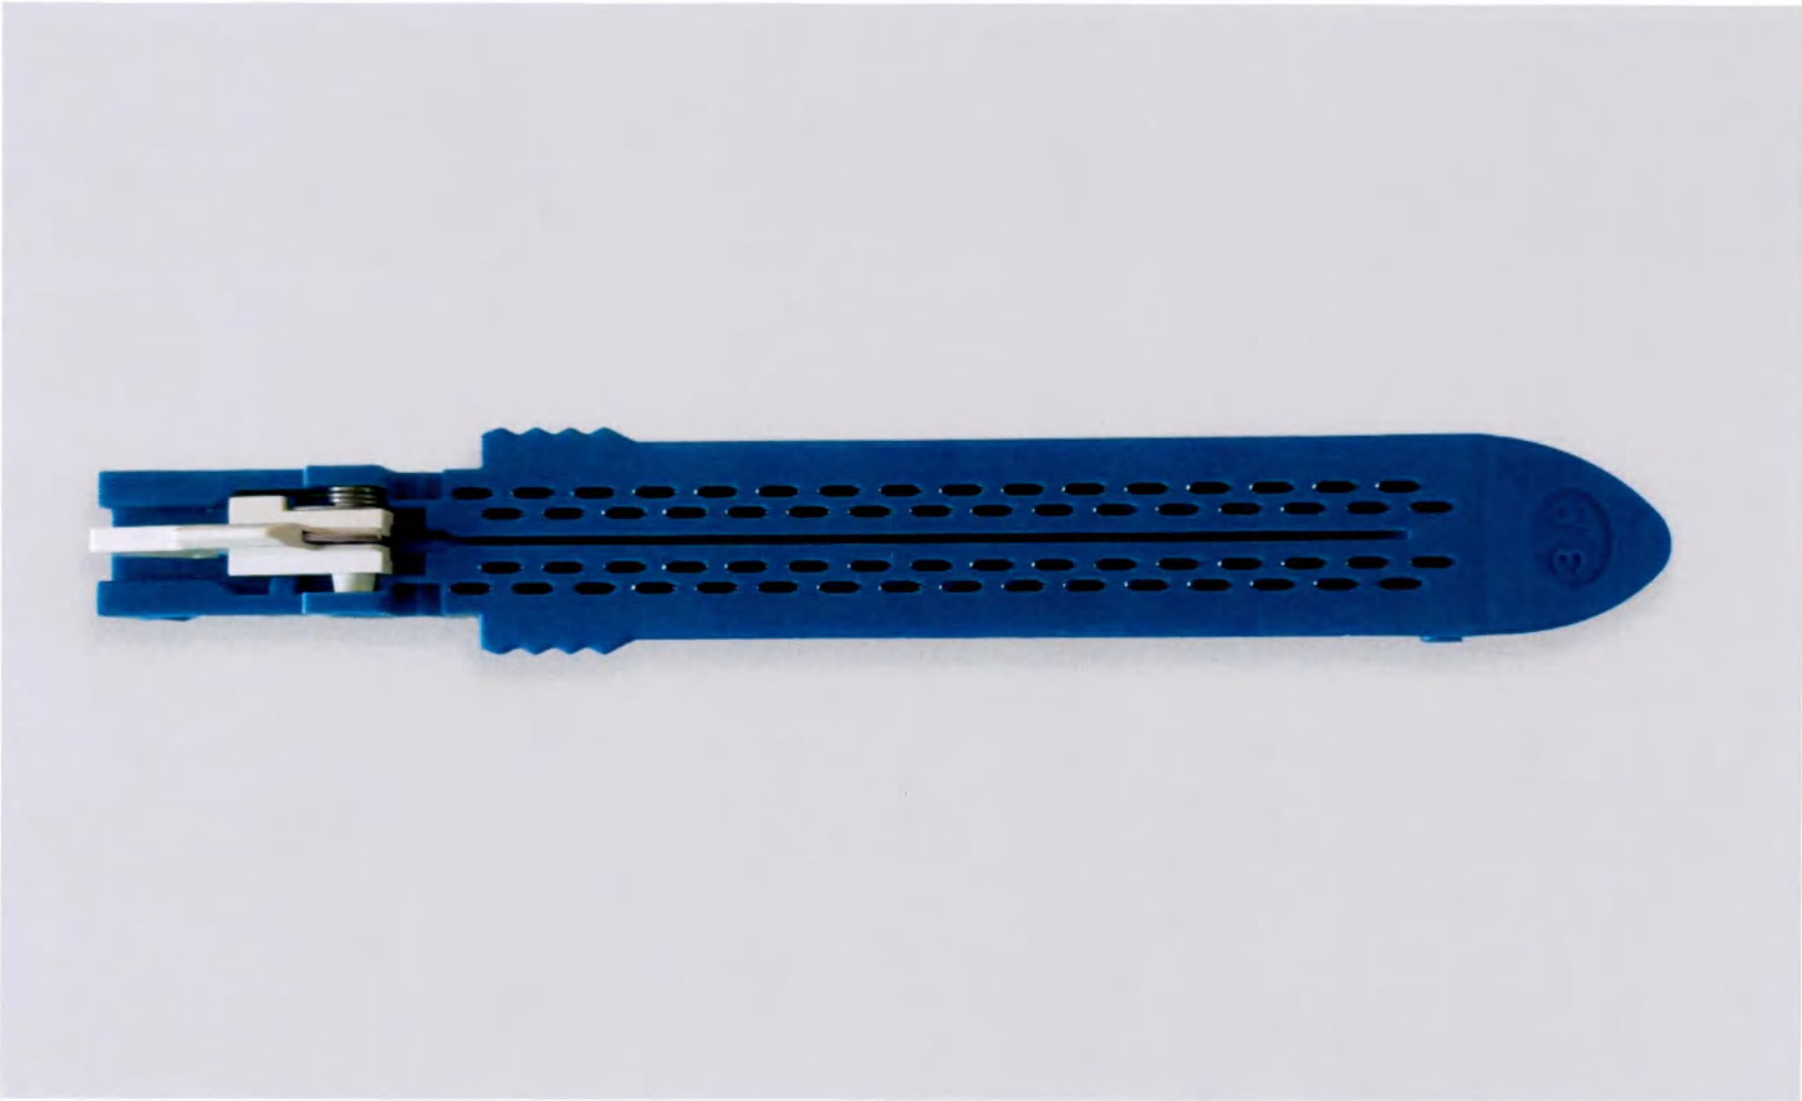

Рисунок 7 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 8 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

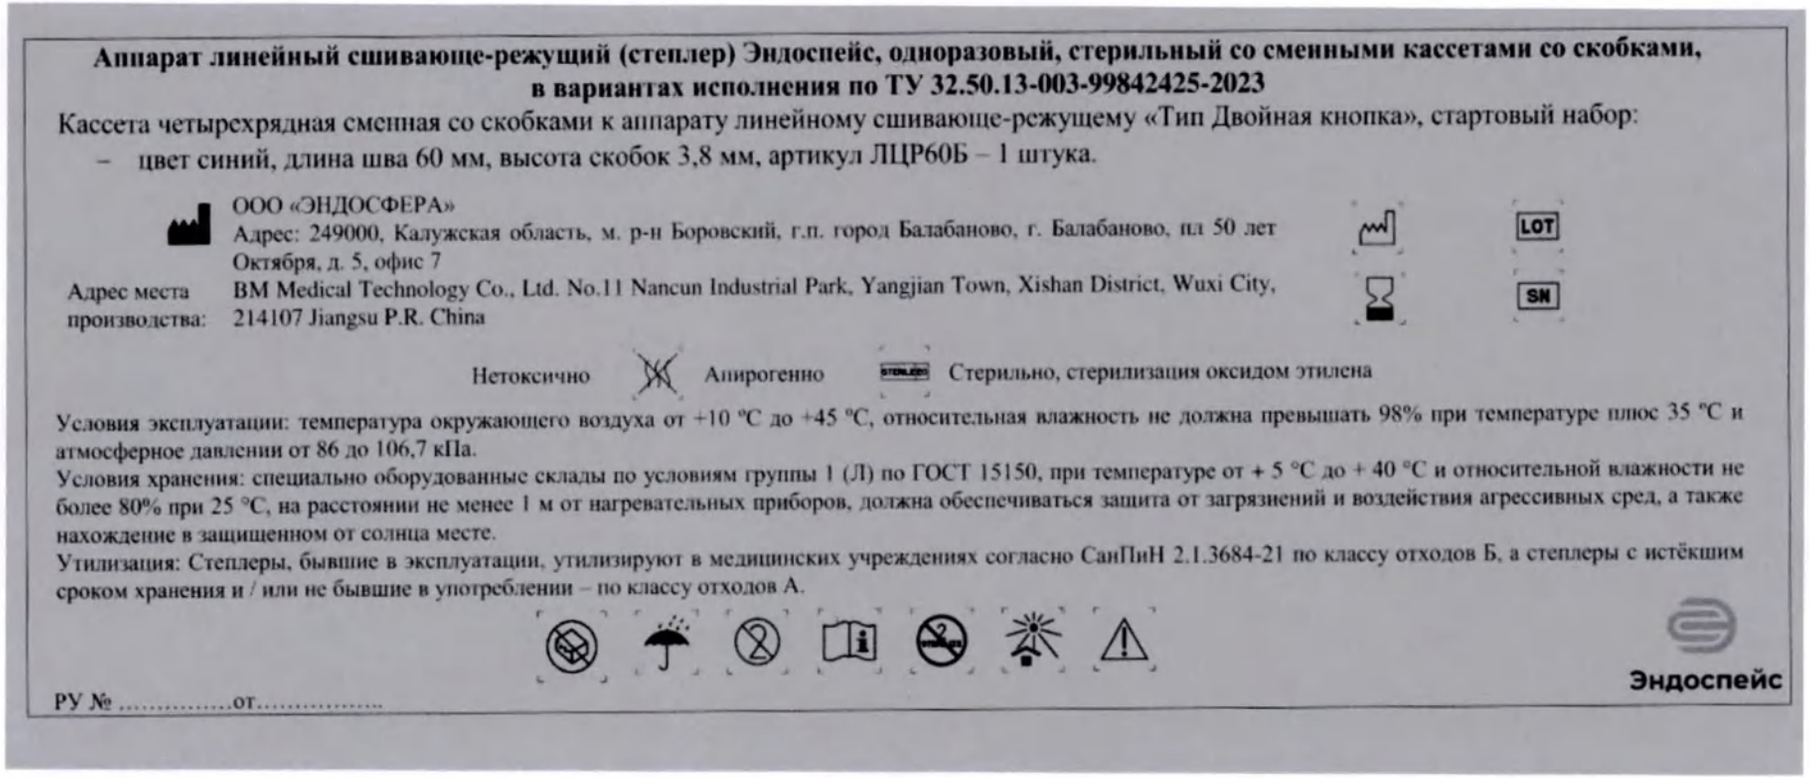

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно STERILIZED Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 8А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

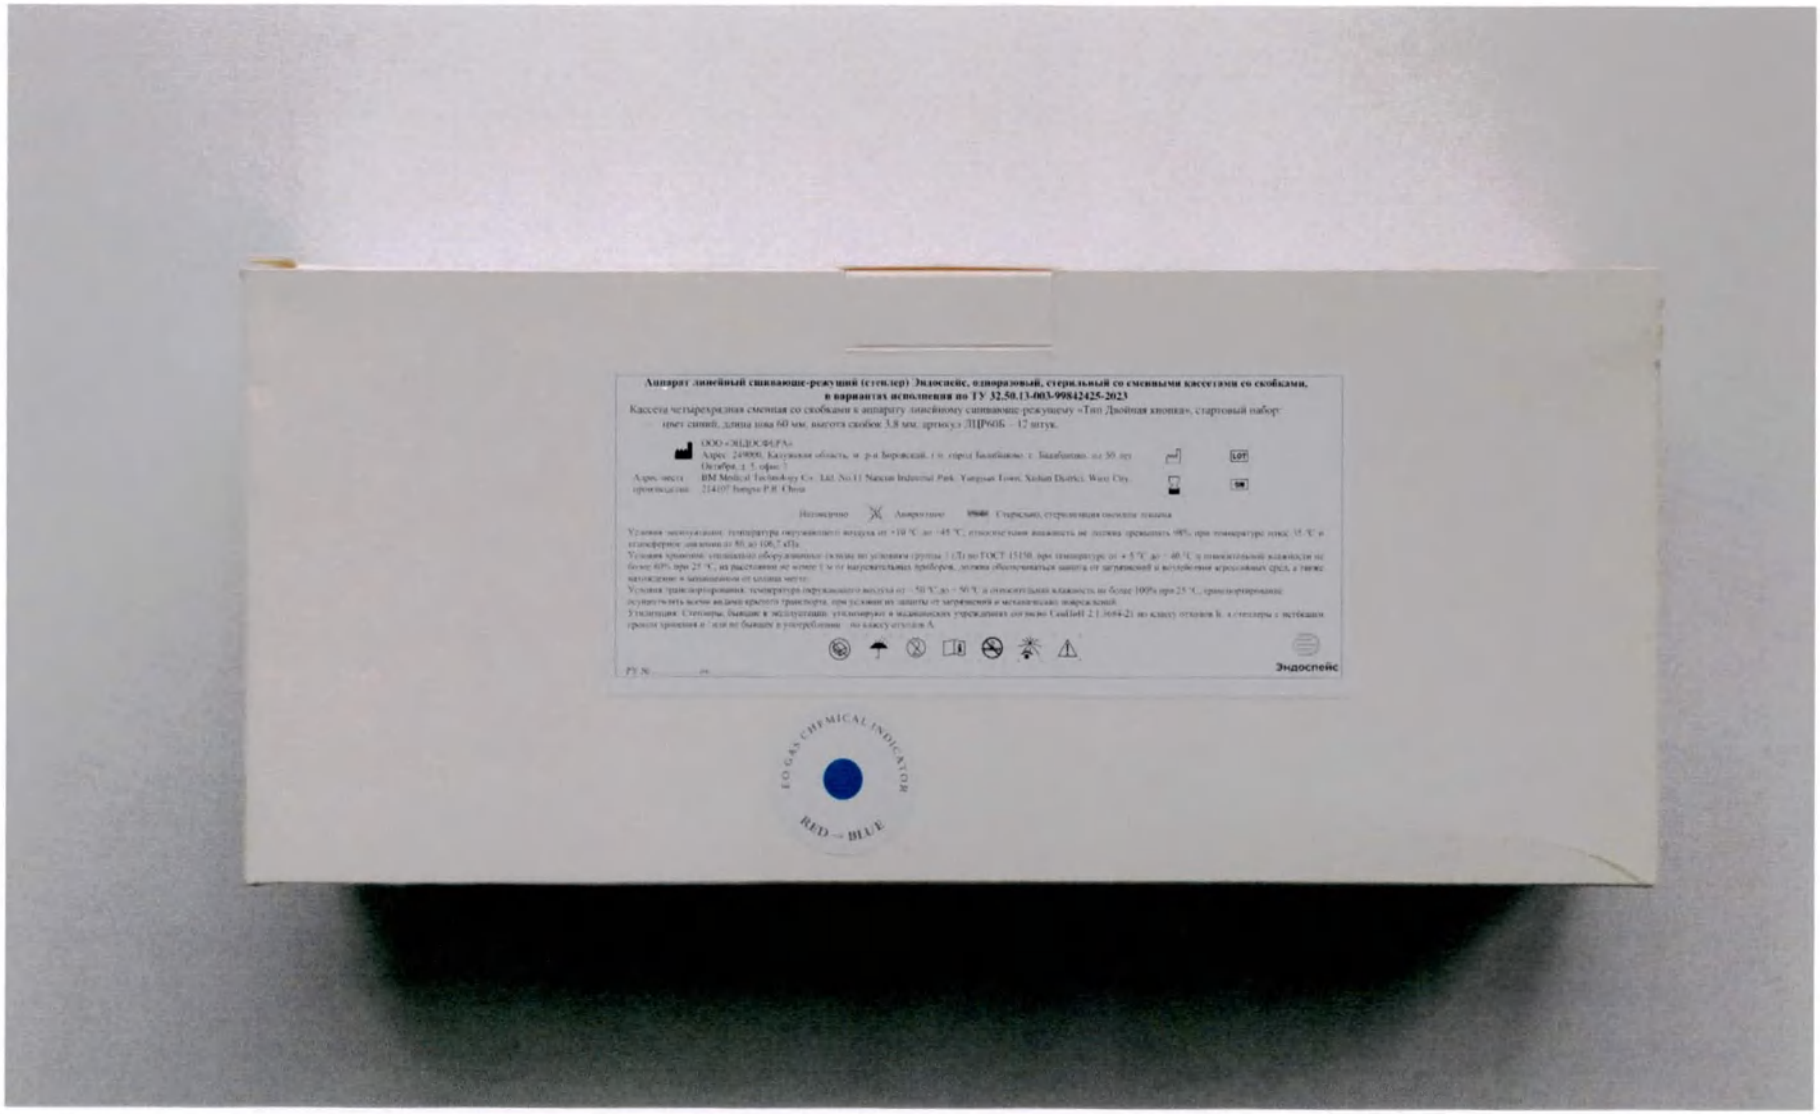

Рисунок 9 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

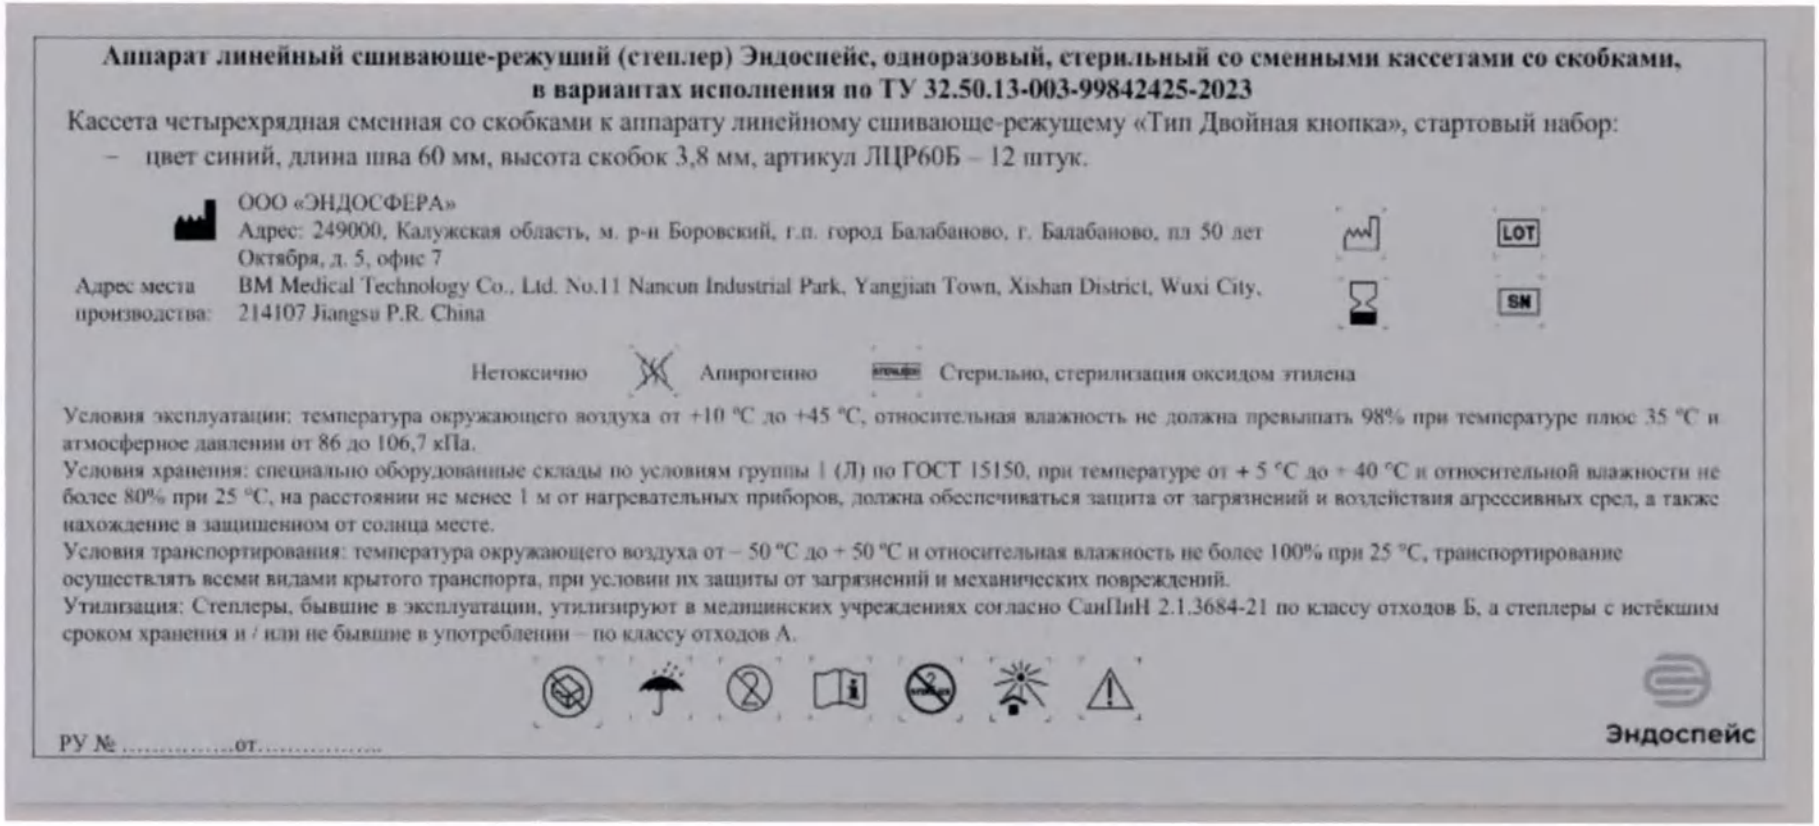

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

Рисунок 9А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 10 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 10А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

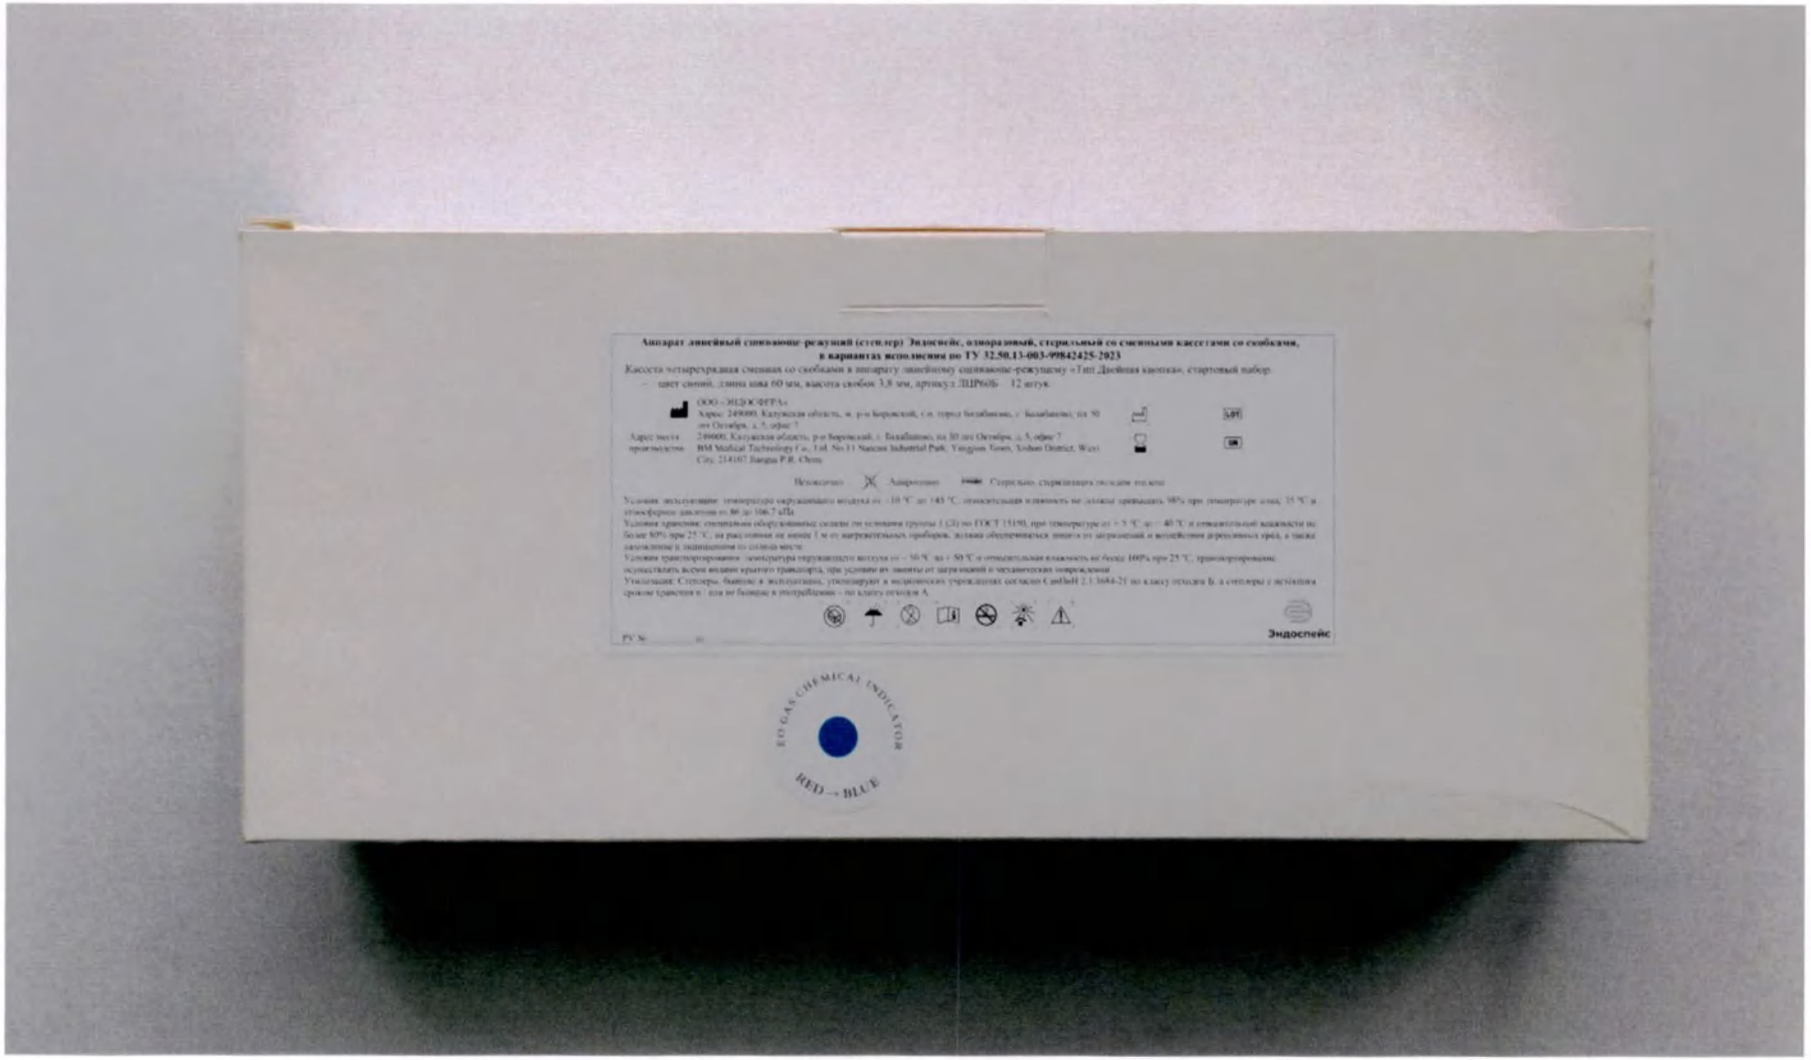

Рисунок 11 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

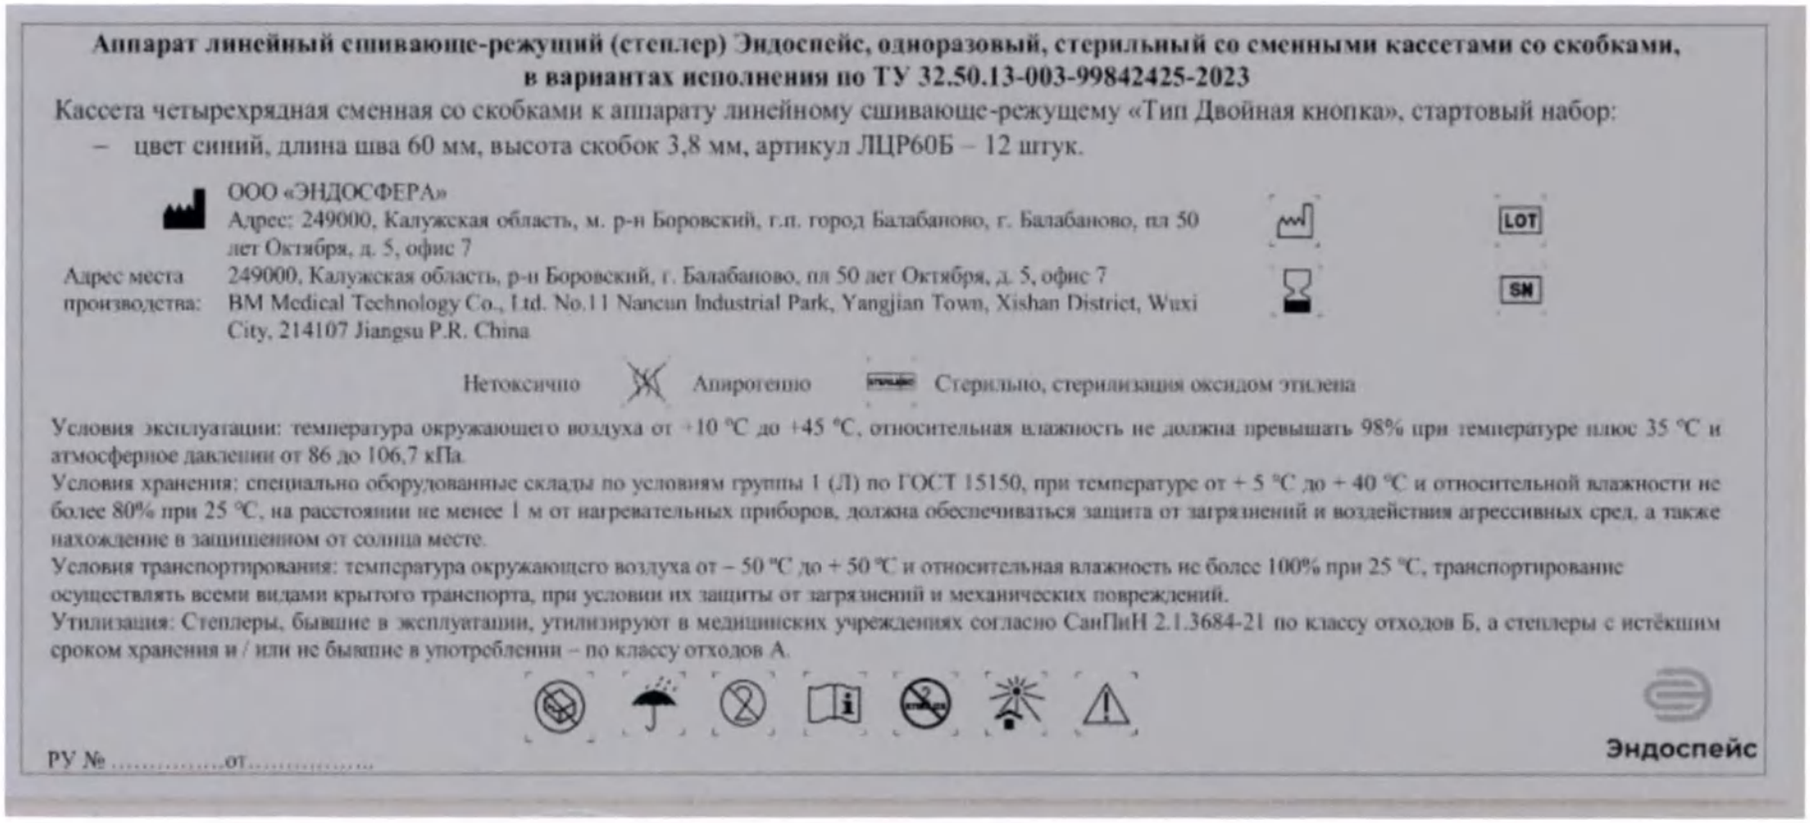

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 11А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 12 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

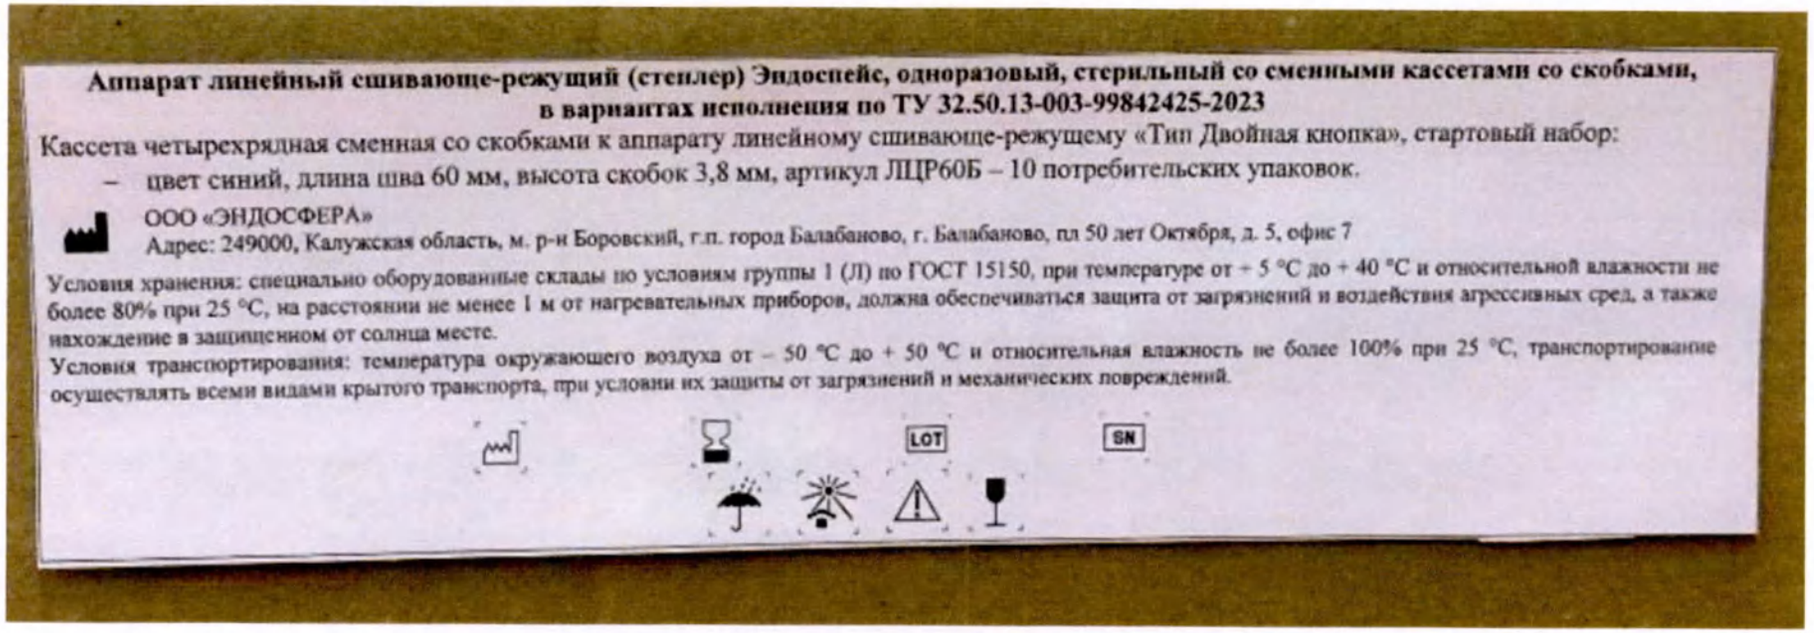

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 12А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

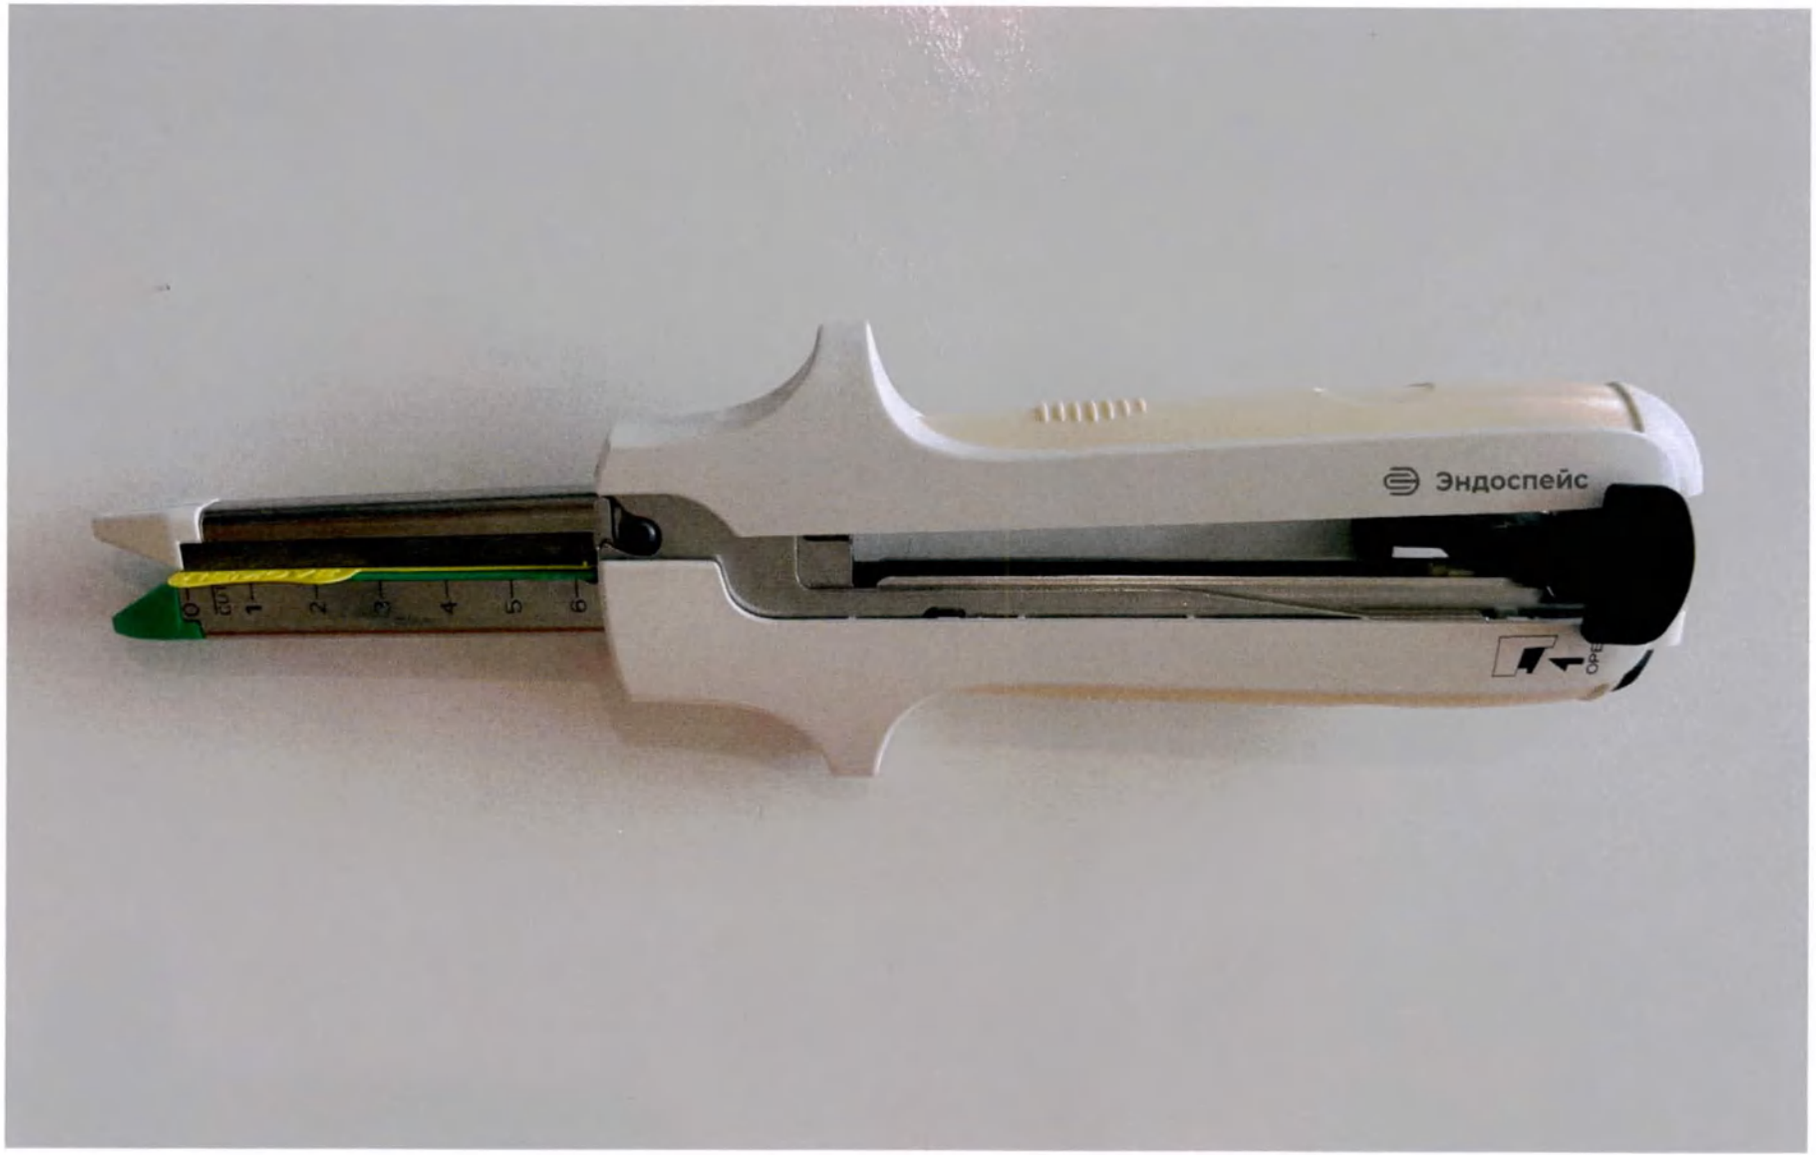

Рисунок 13 - Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 14 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 14А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

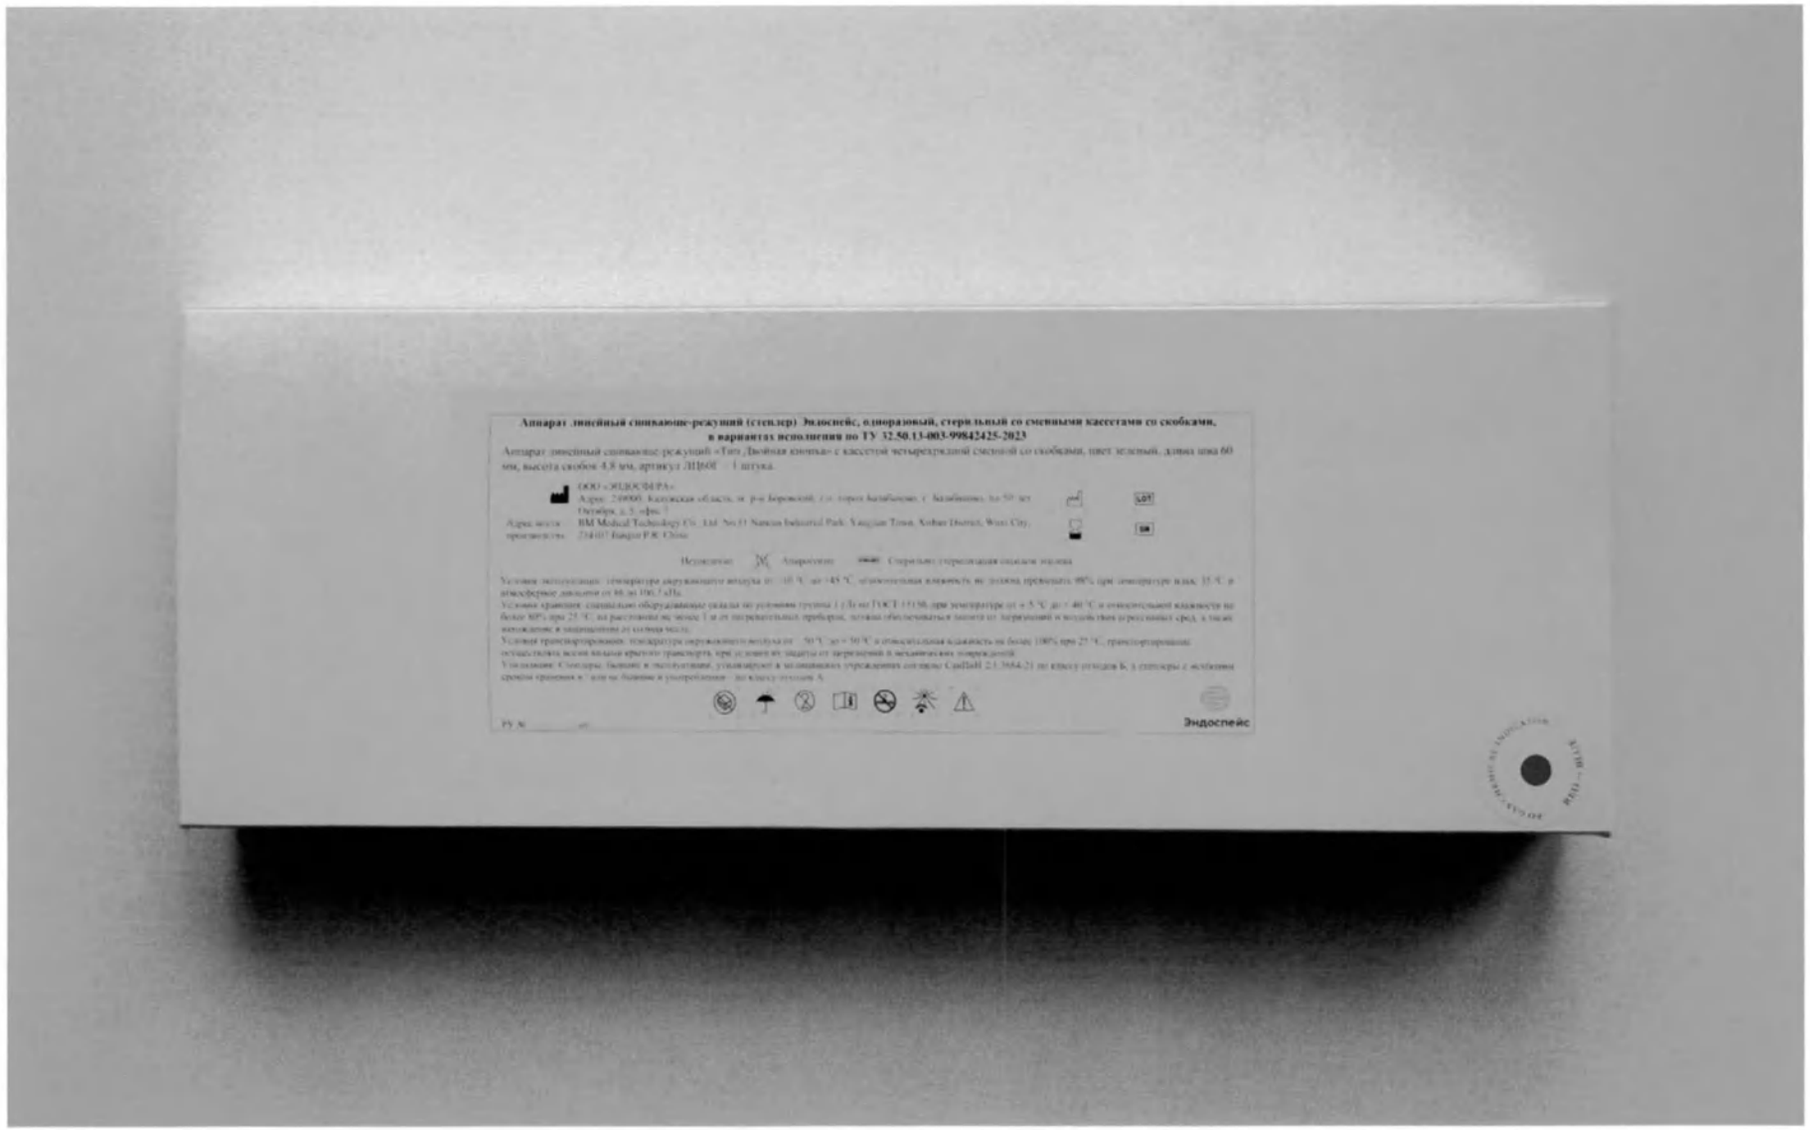

Рисунок 15 - Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

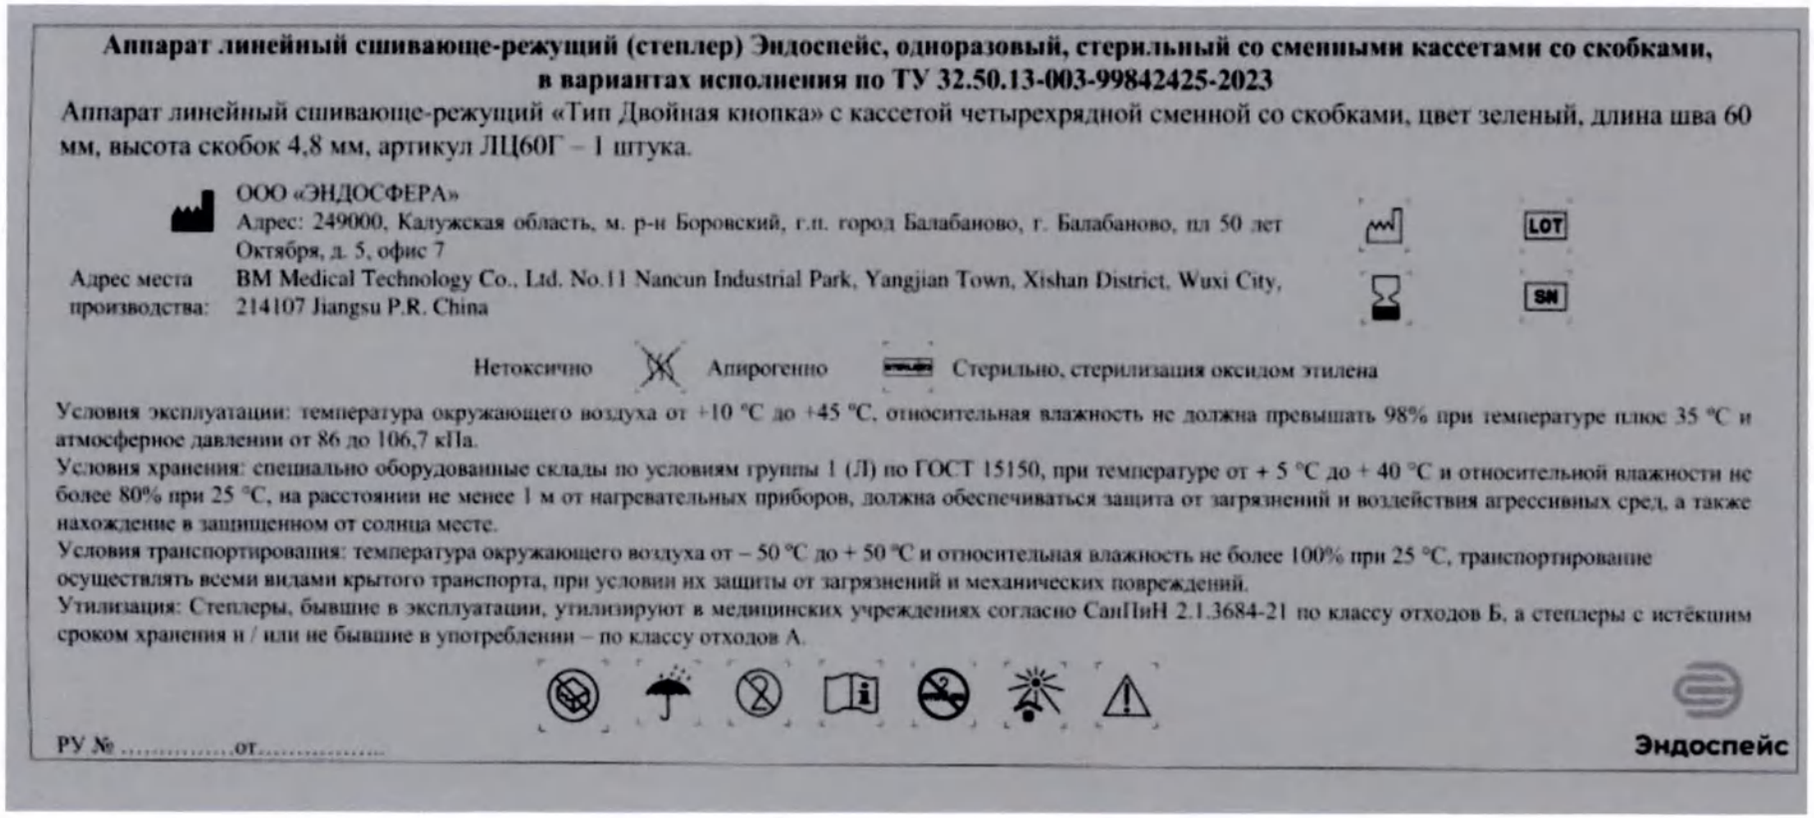

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 15А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 16 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

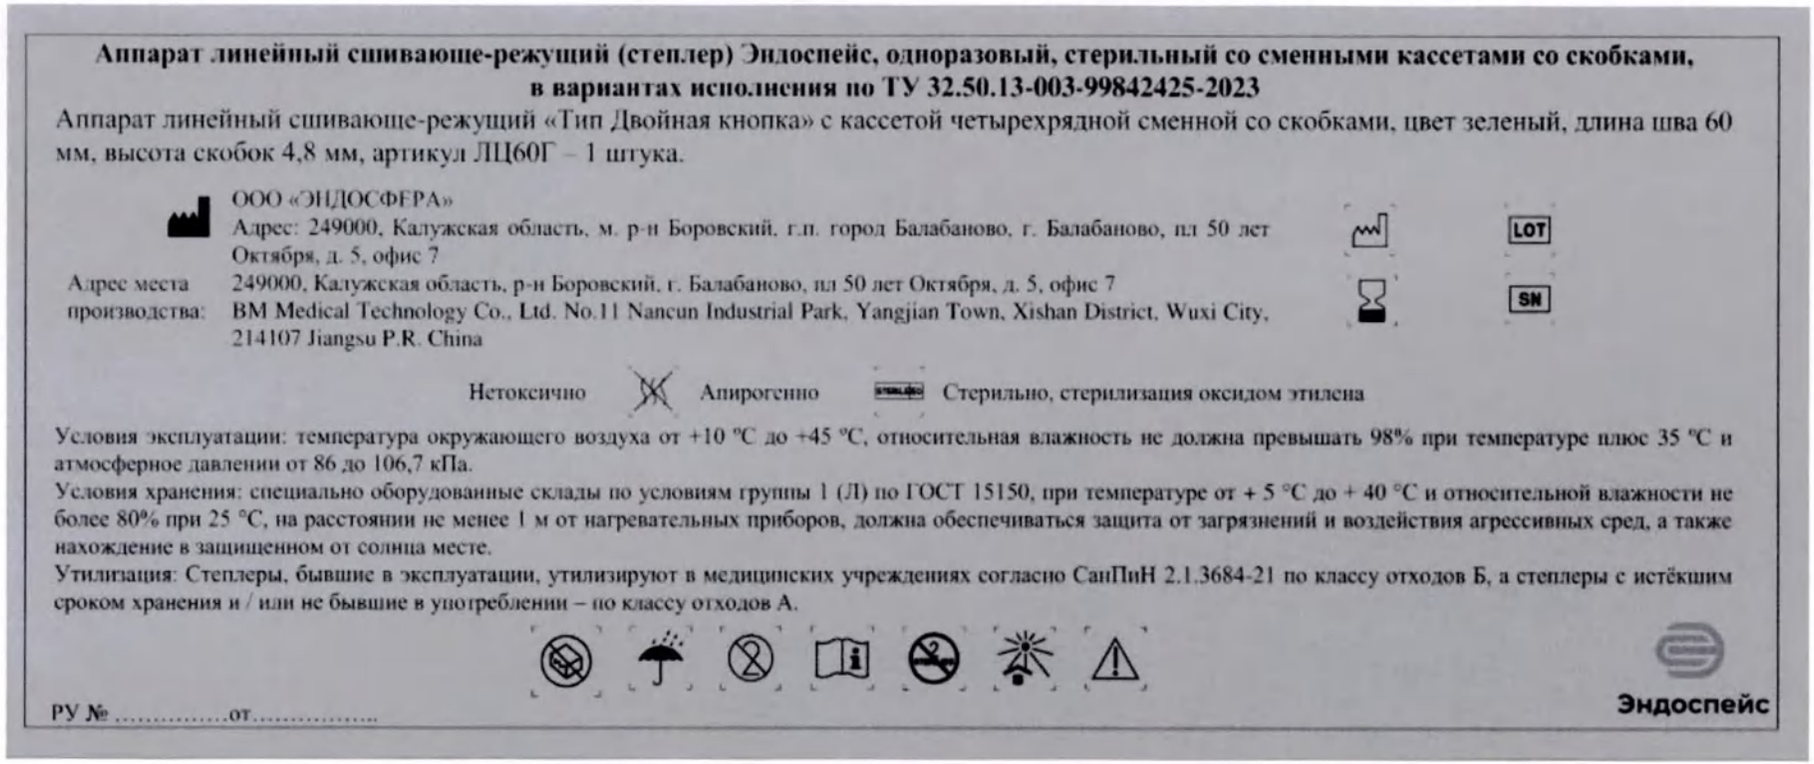

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 16А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

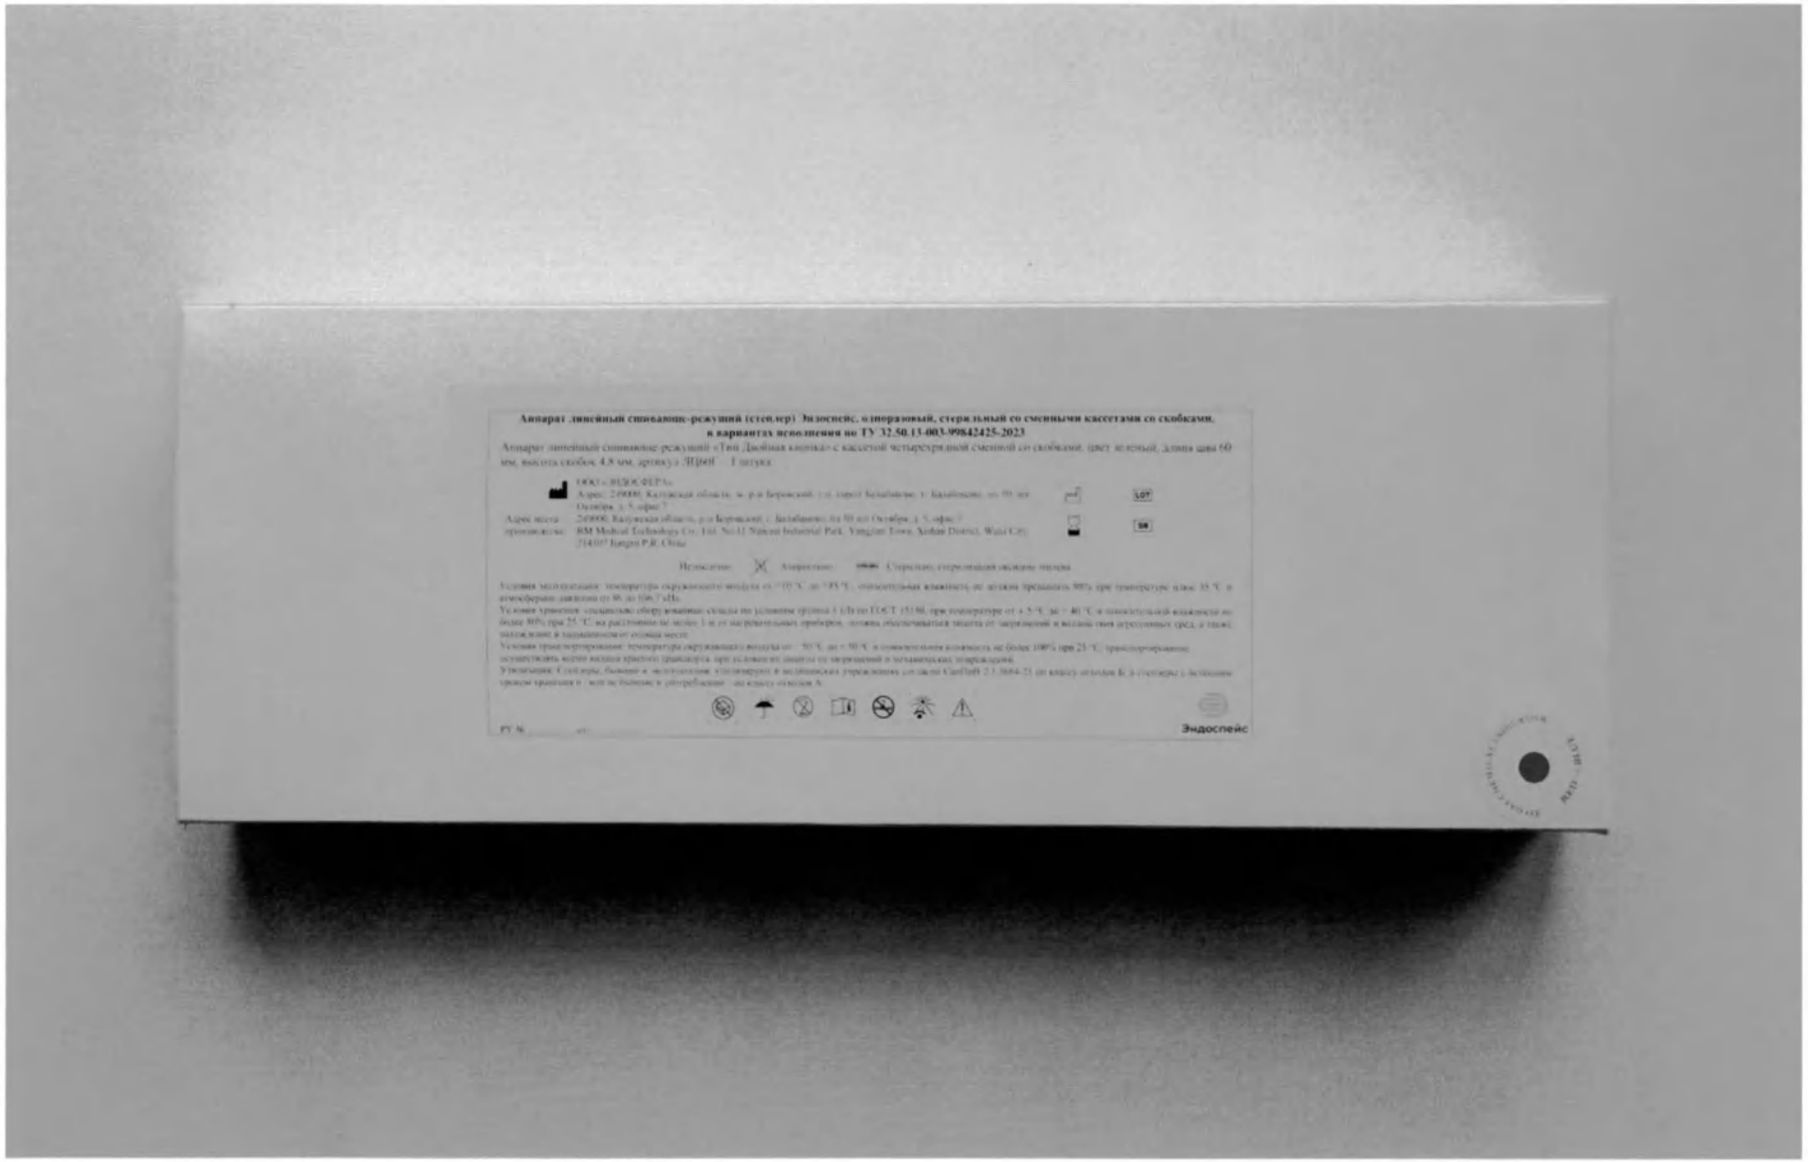

Рисунок 17 - Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

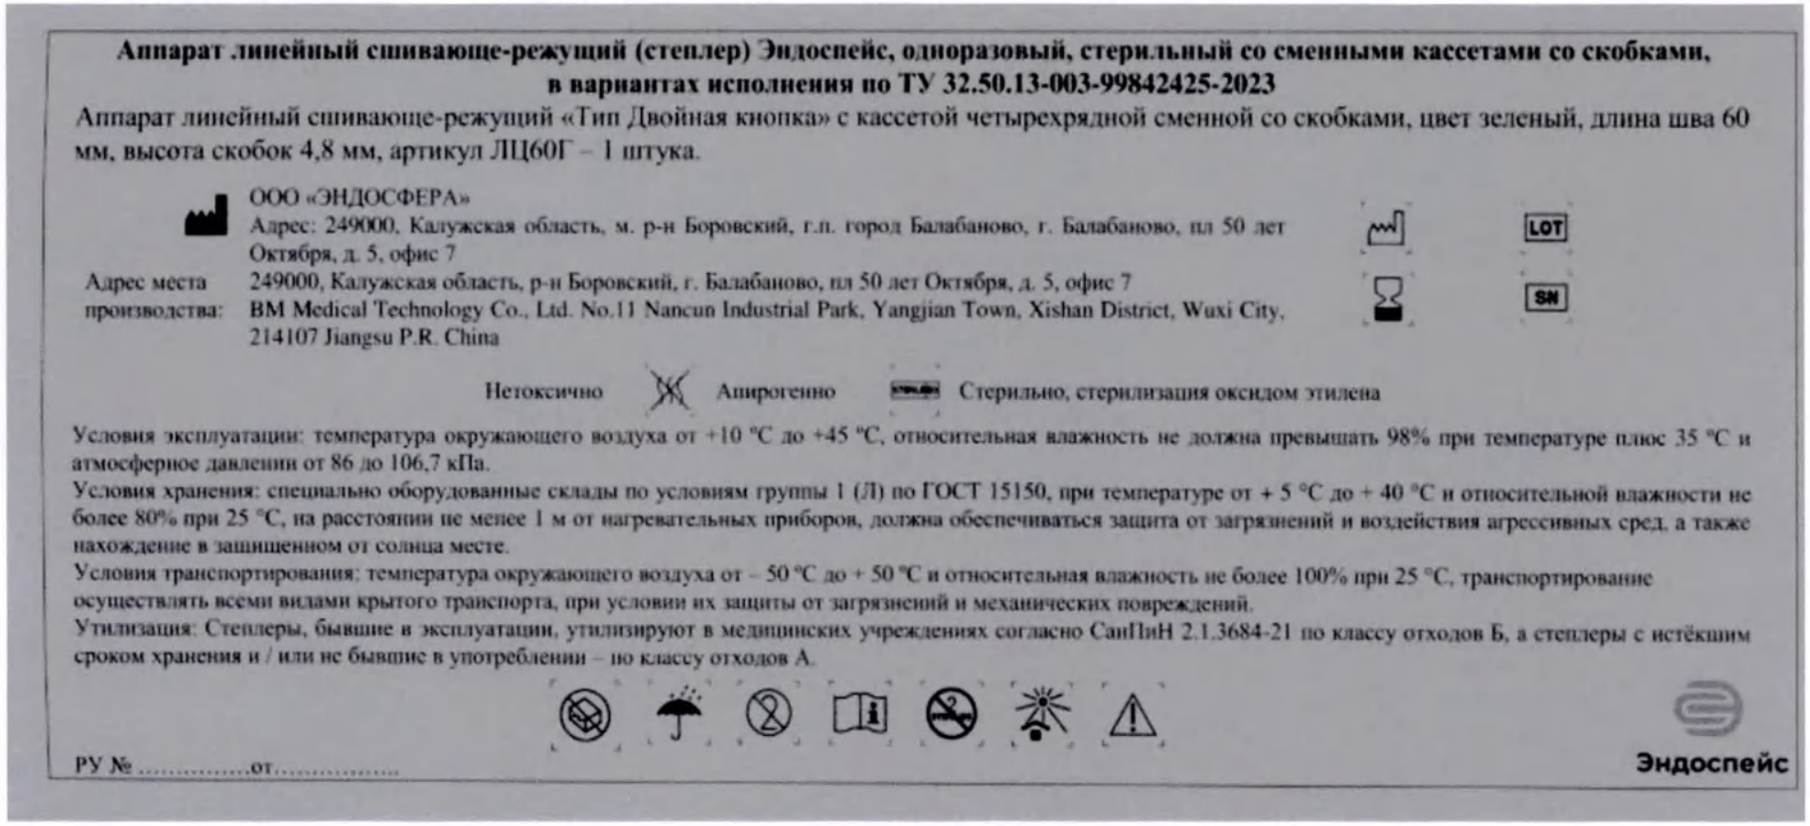

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 17А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 18 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

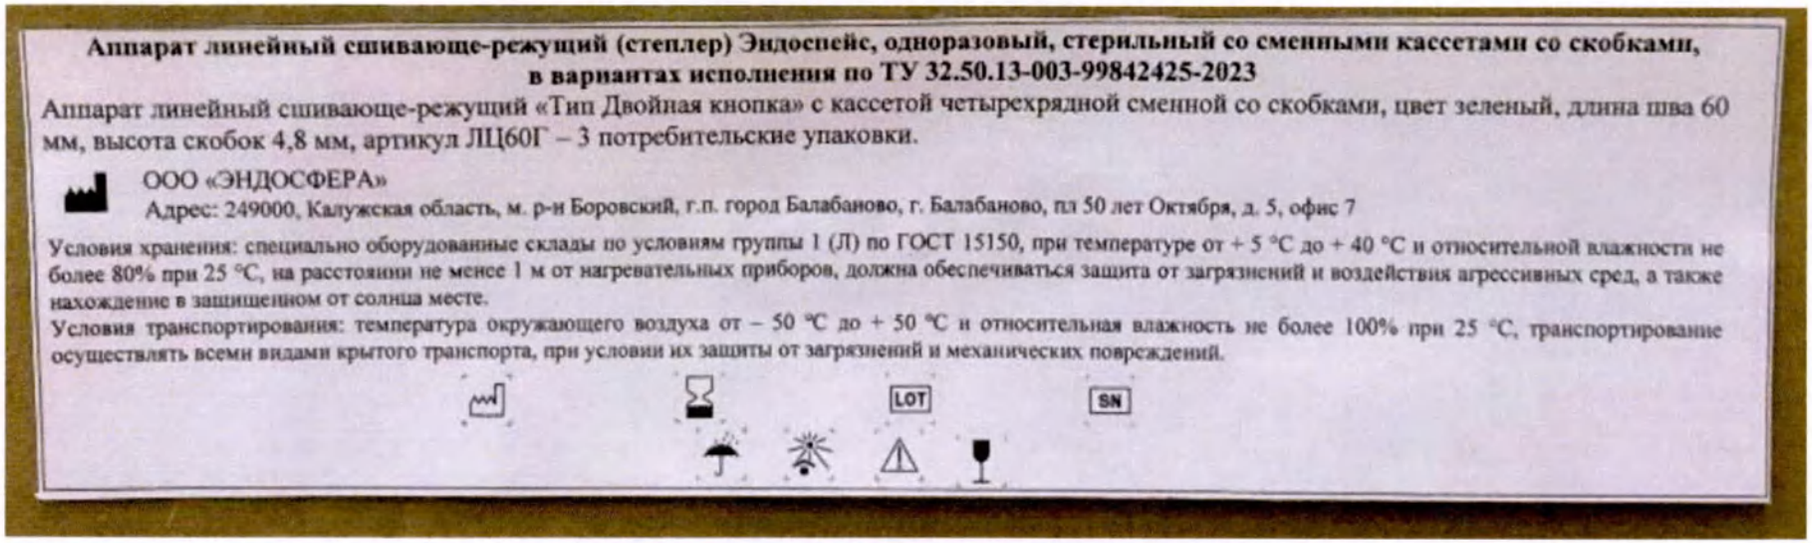

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 18А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

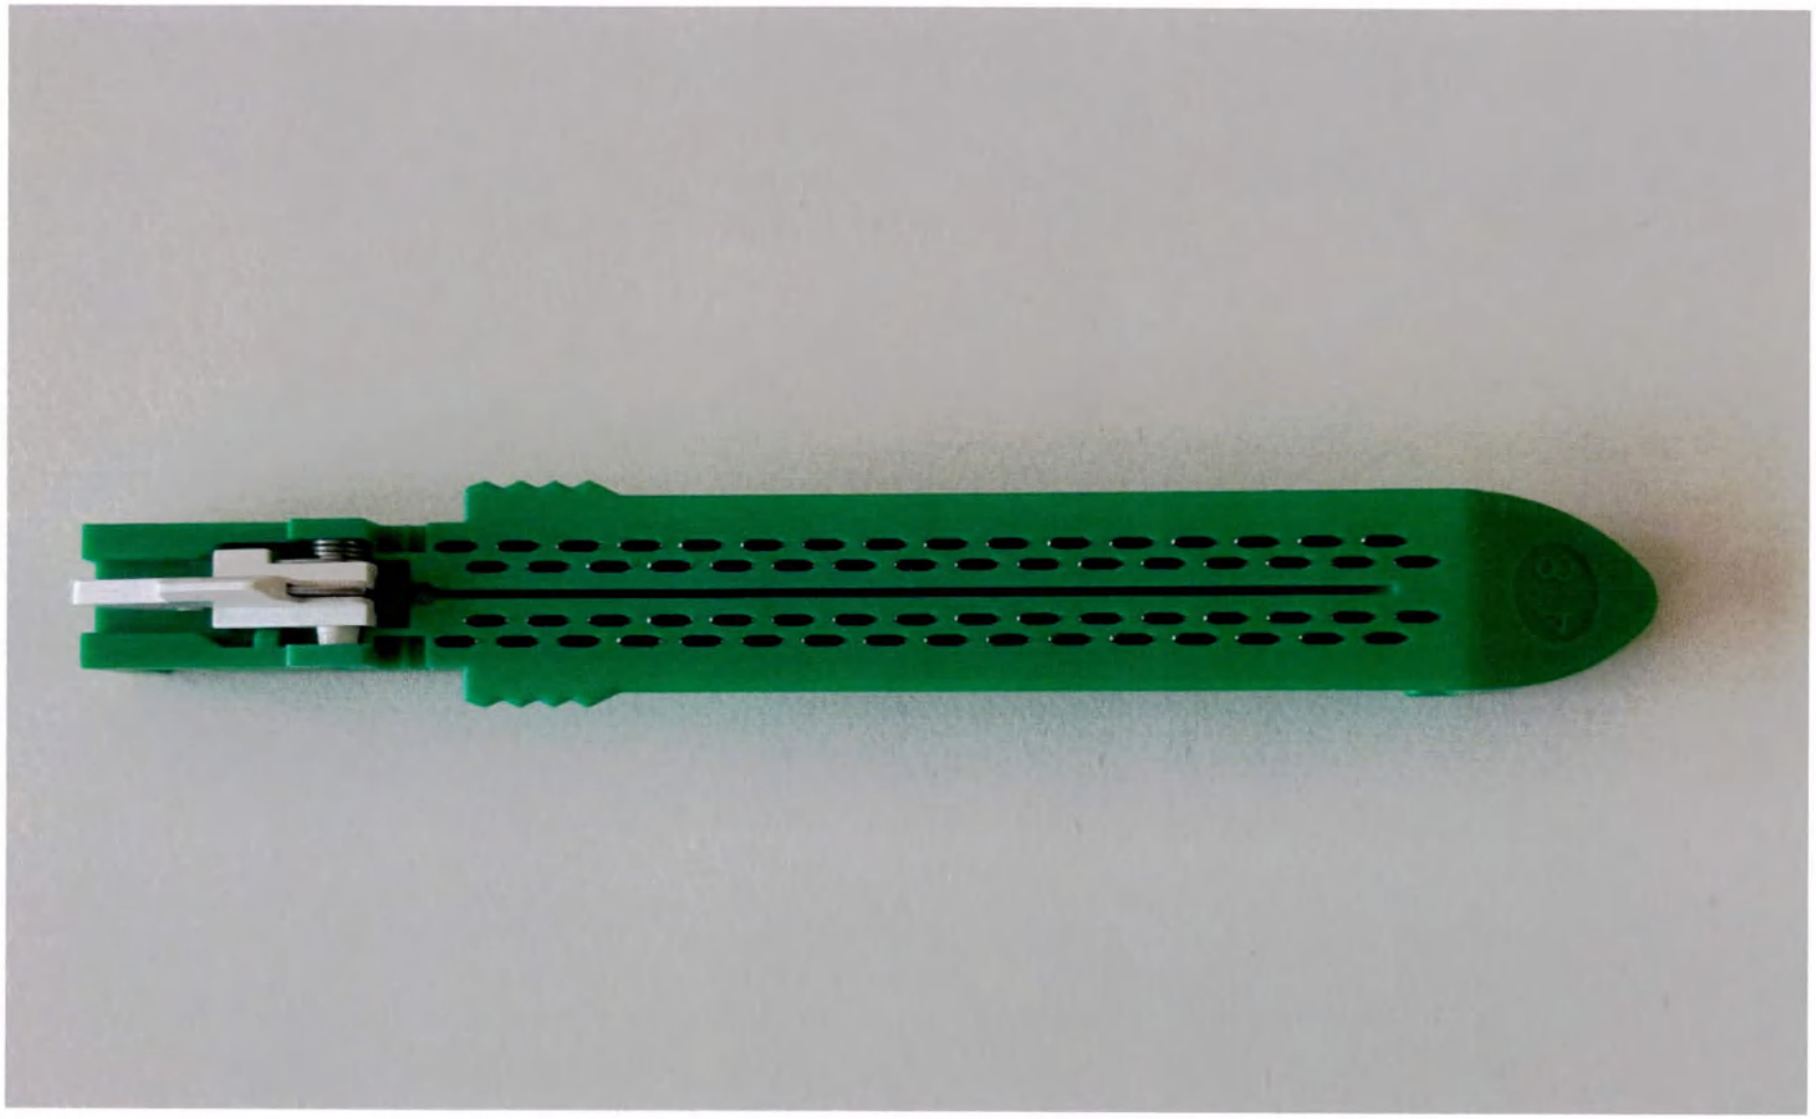

Рисунок 19 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 20 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 20А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 21 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

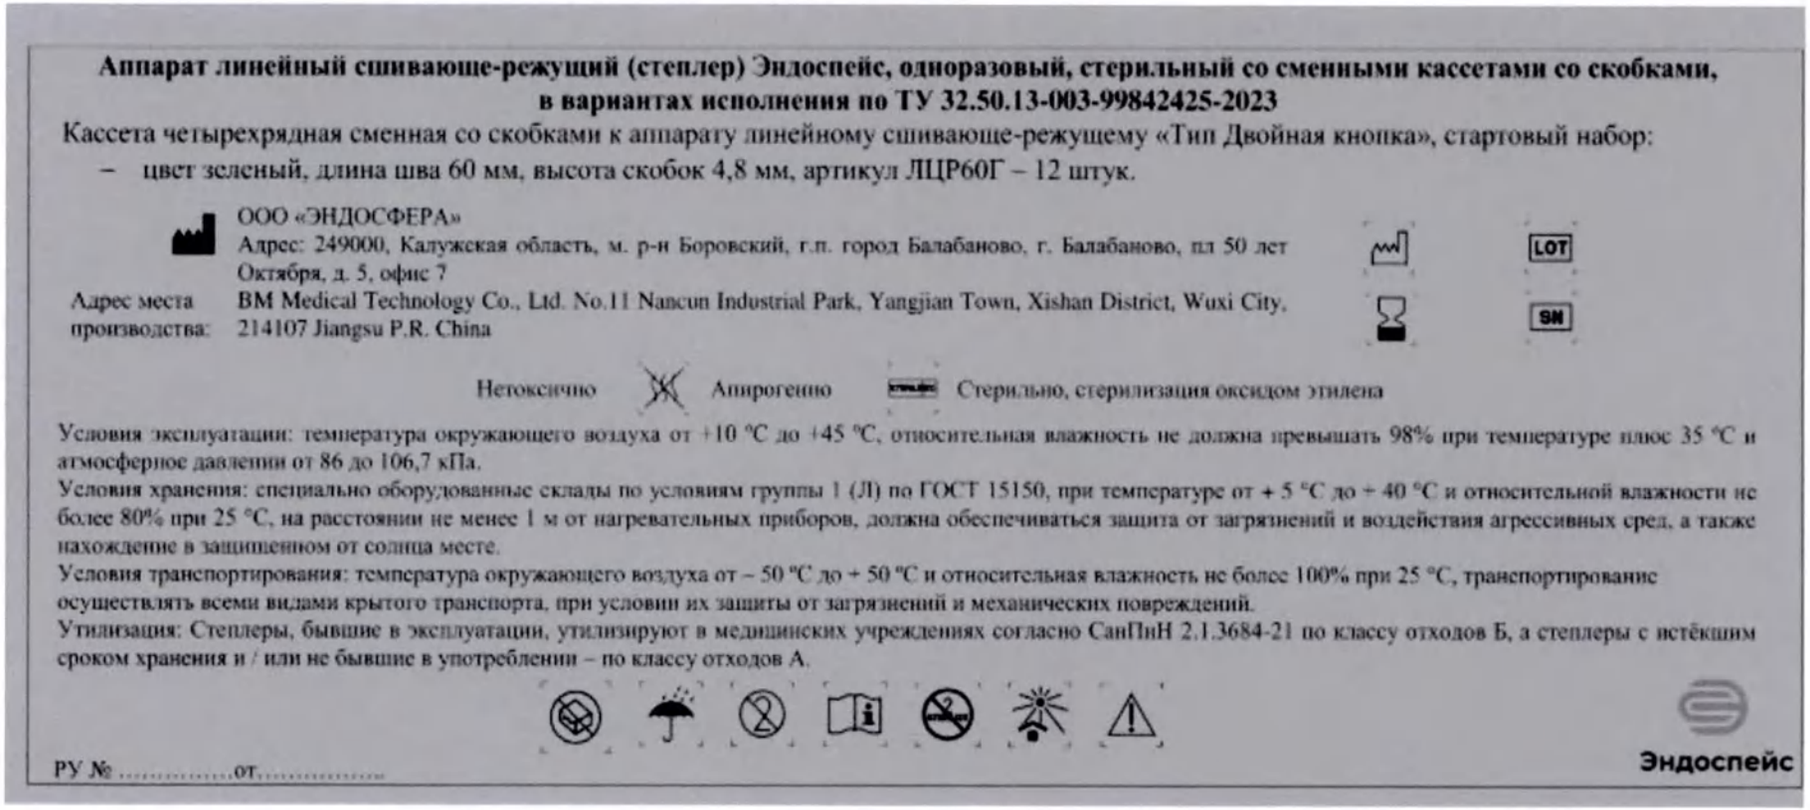

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 21А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 22 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 22А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 23 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 23А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

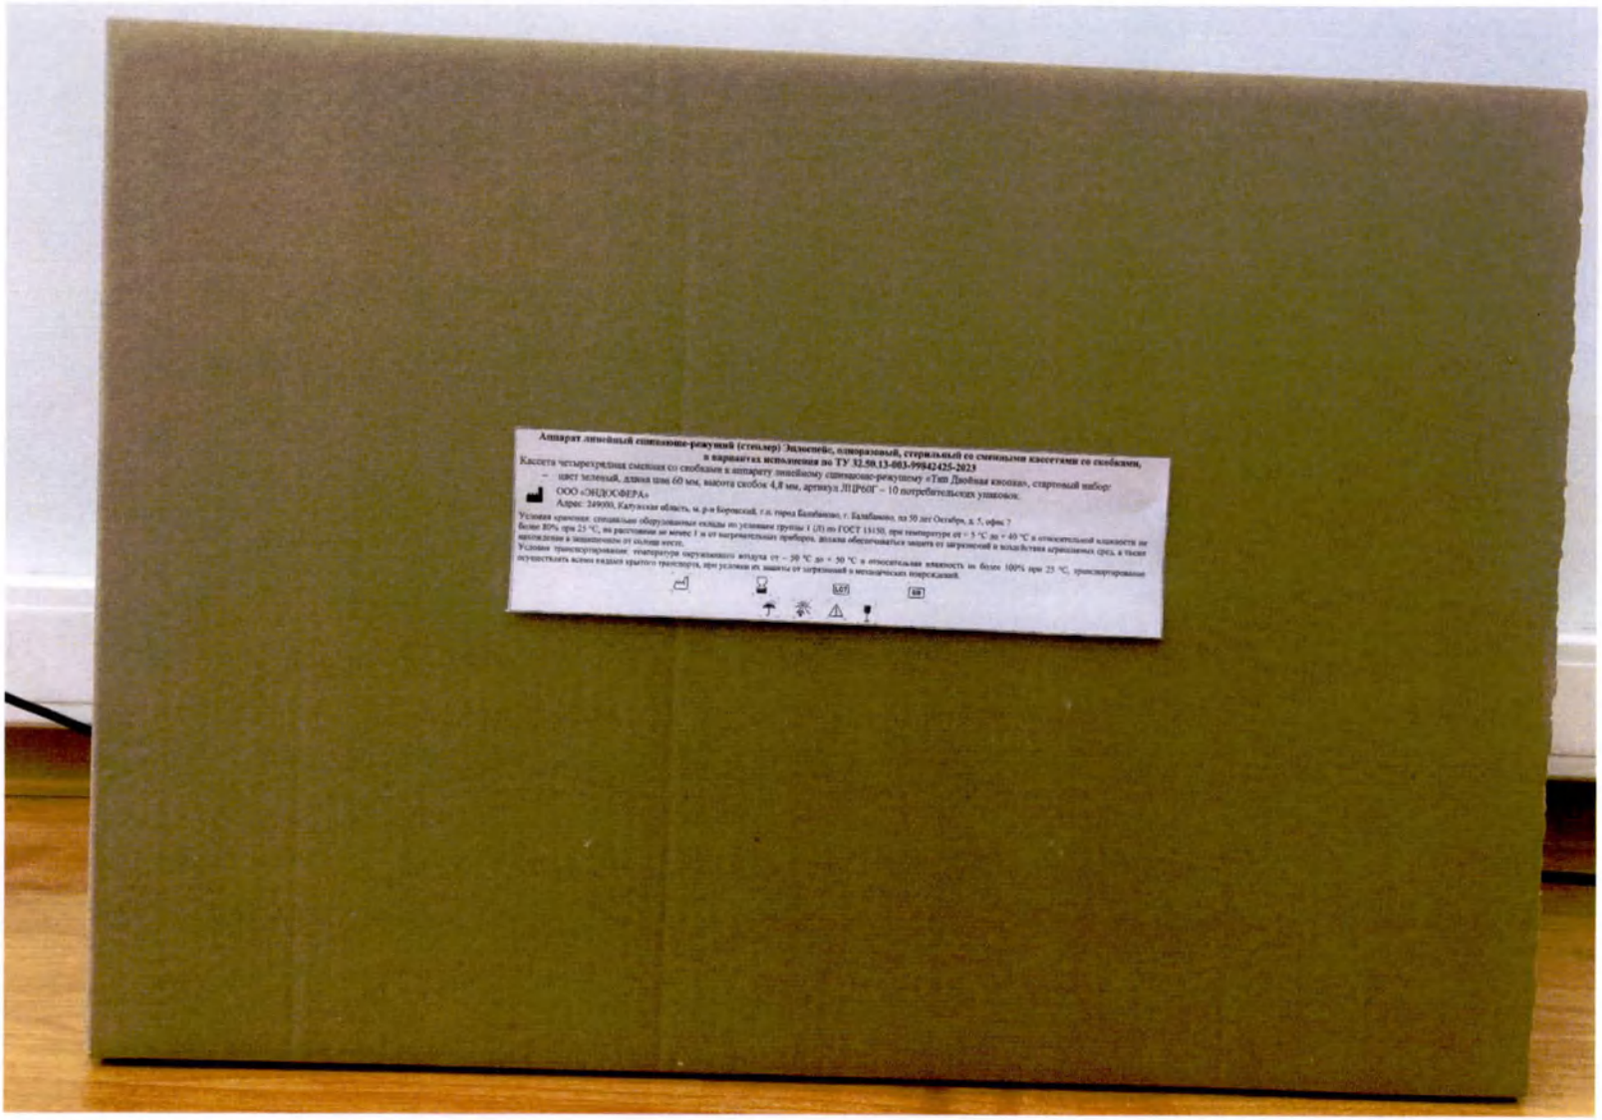

Рисунок 24 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

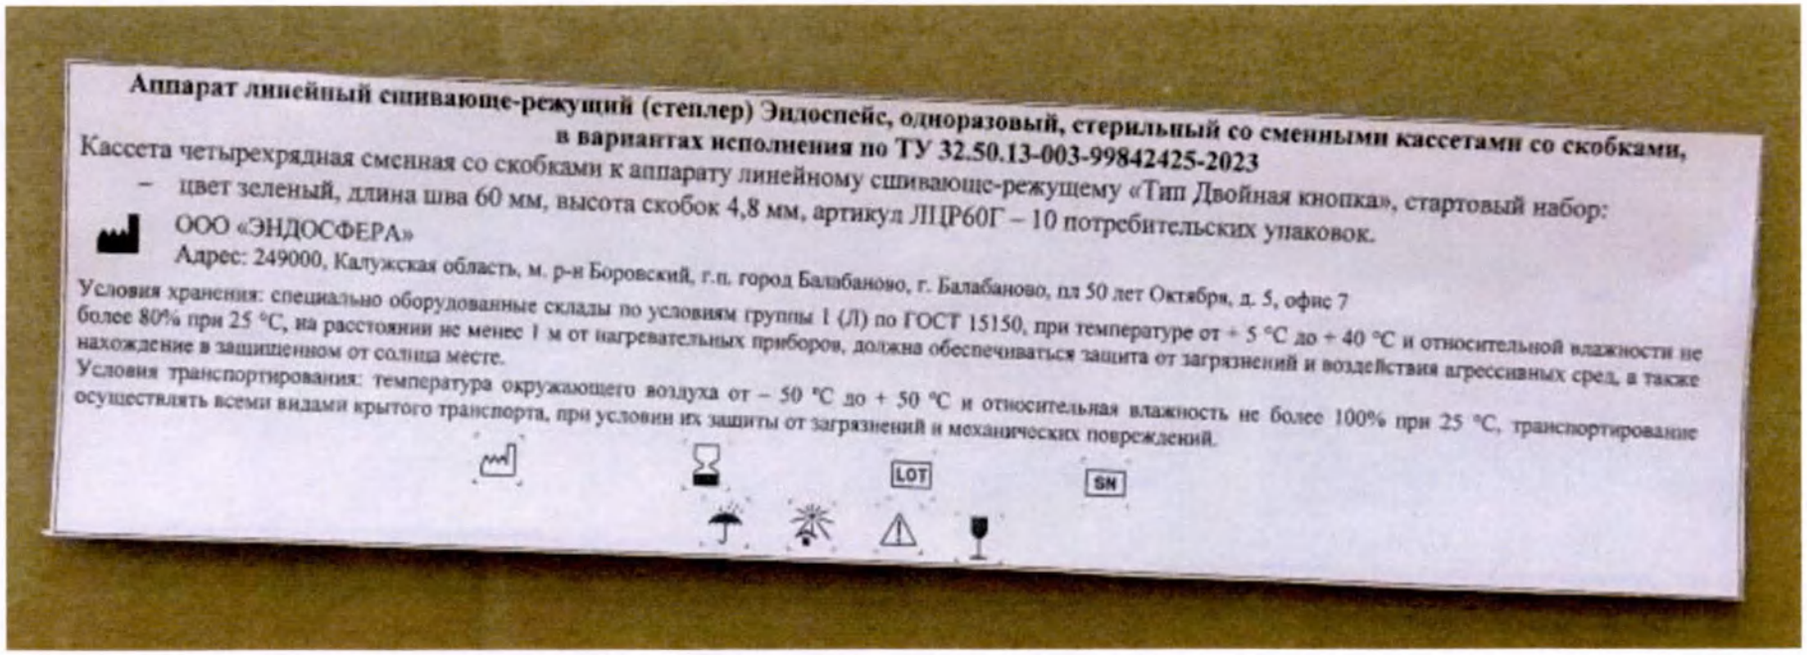

Рисунок 24А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

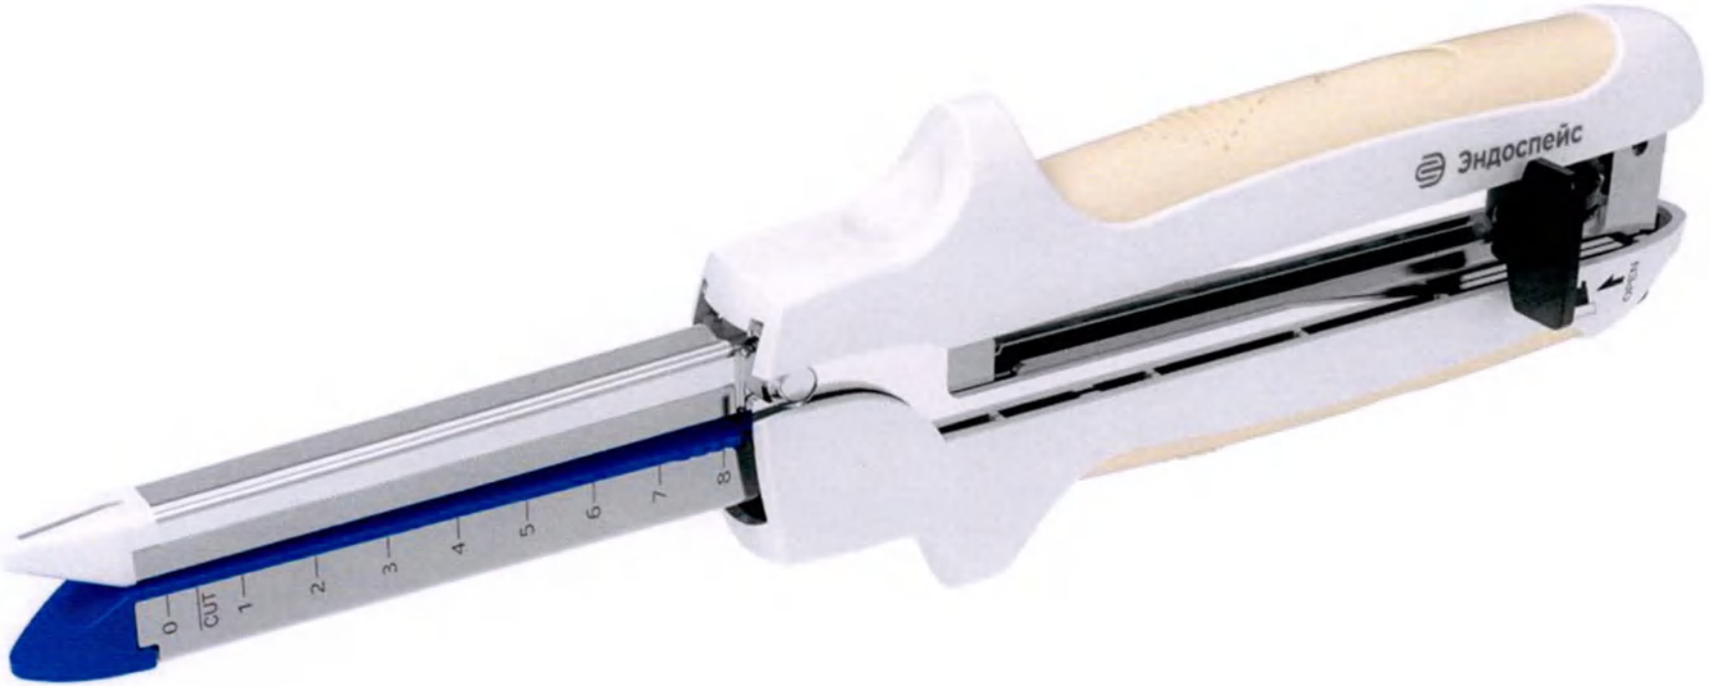

Рисунок 25 – Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

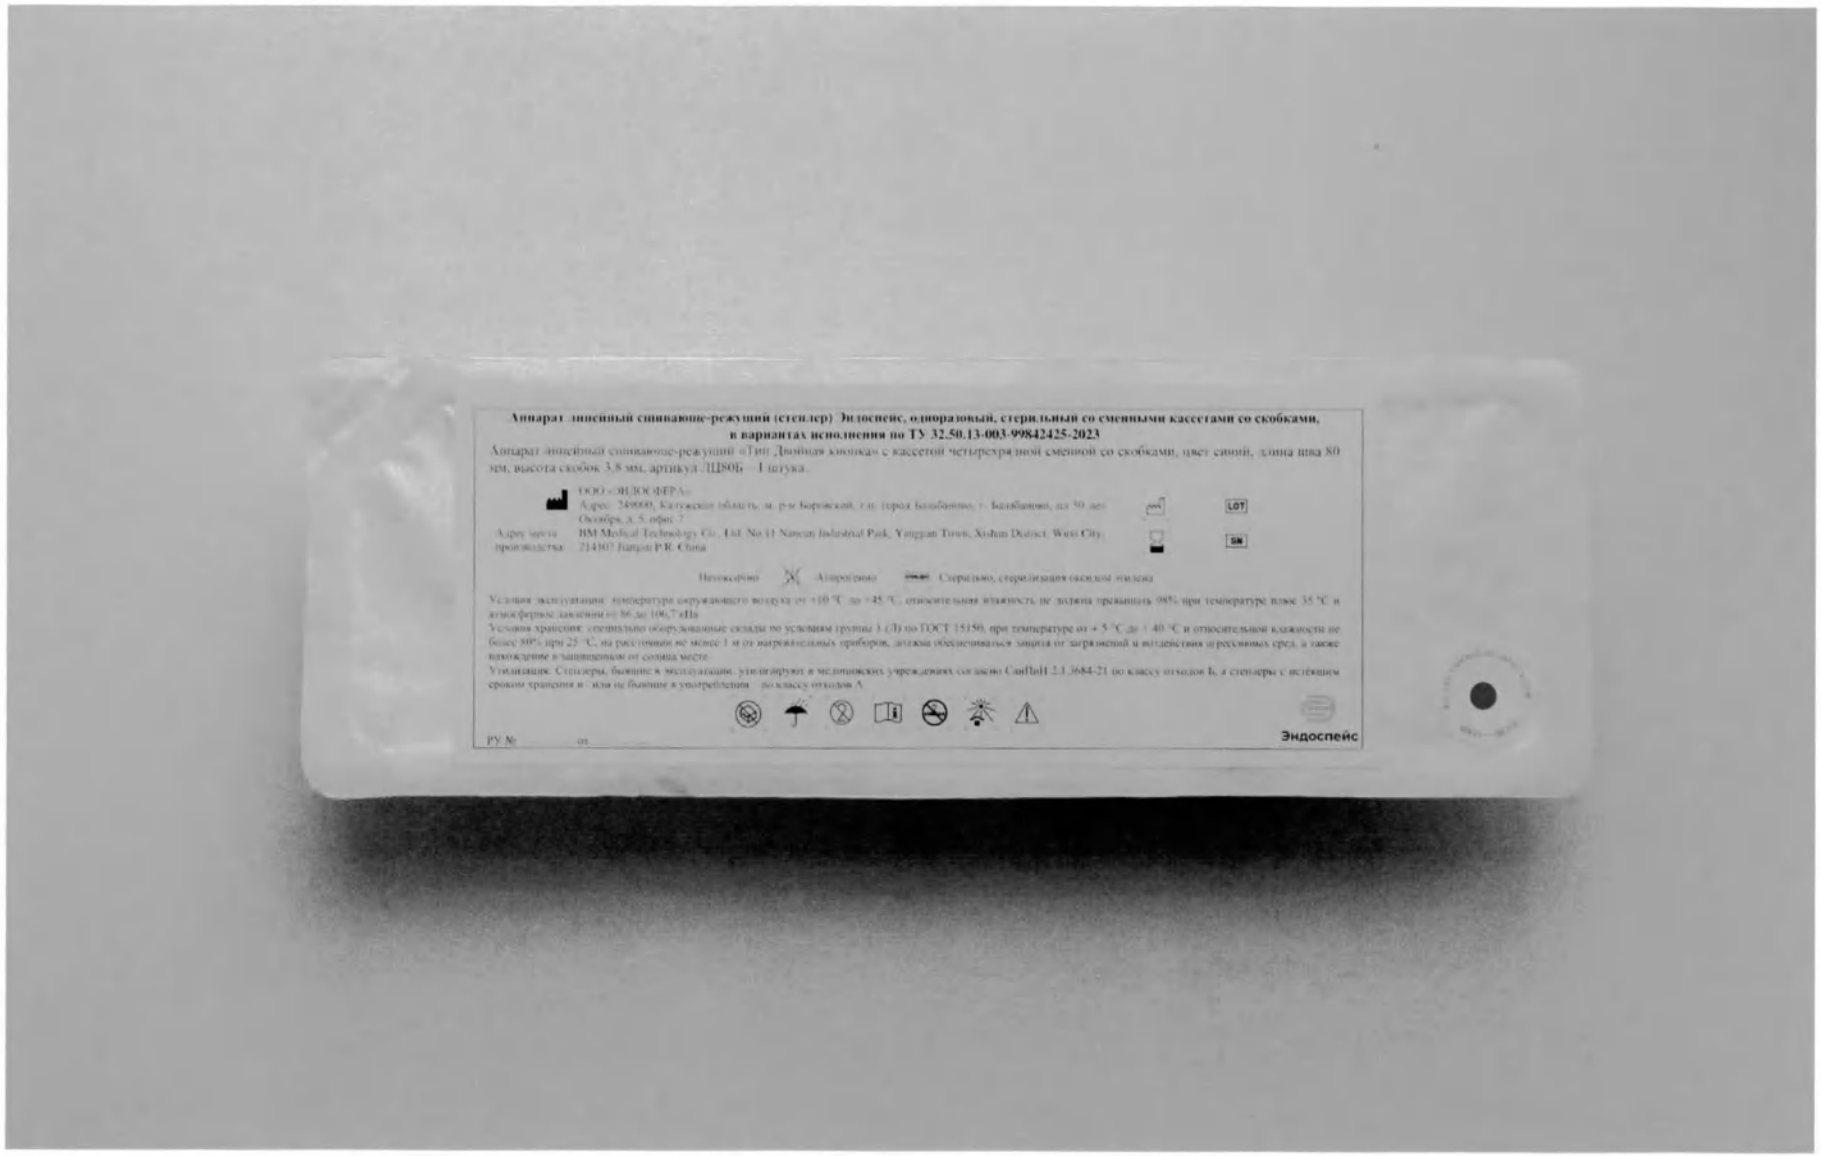

Рисунок 26 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

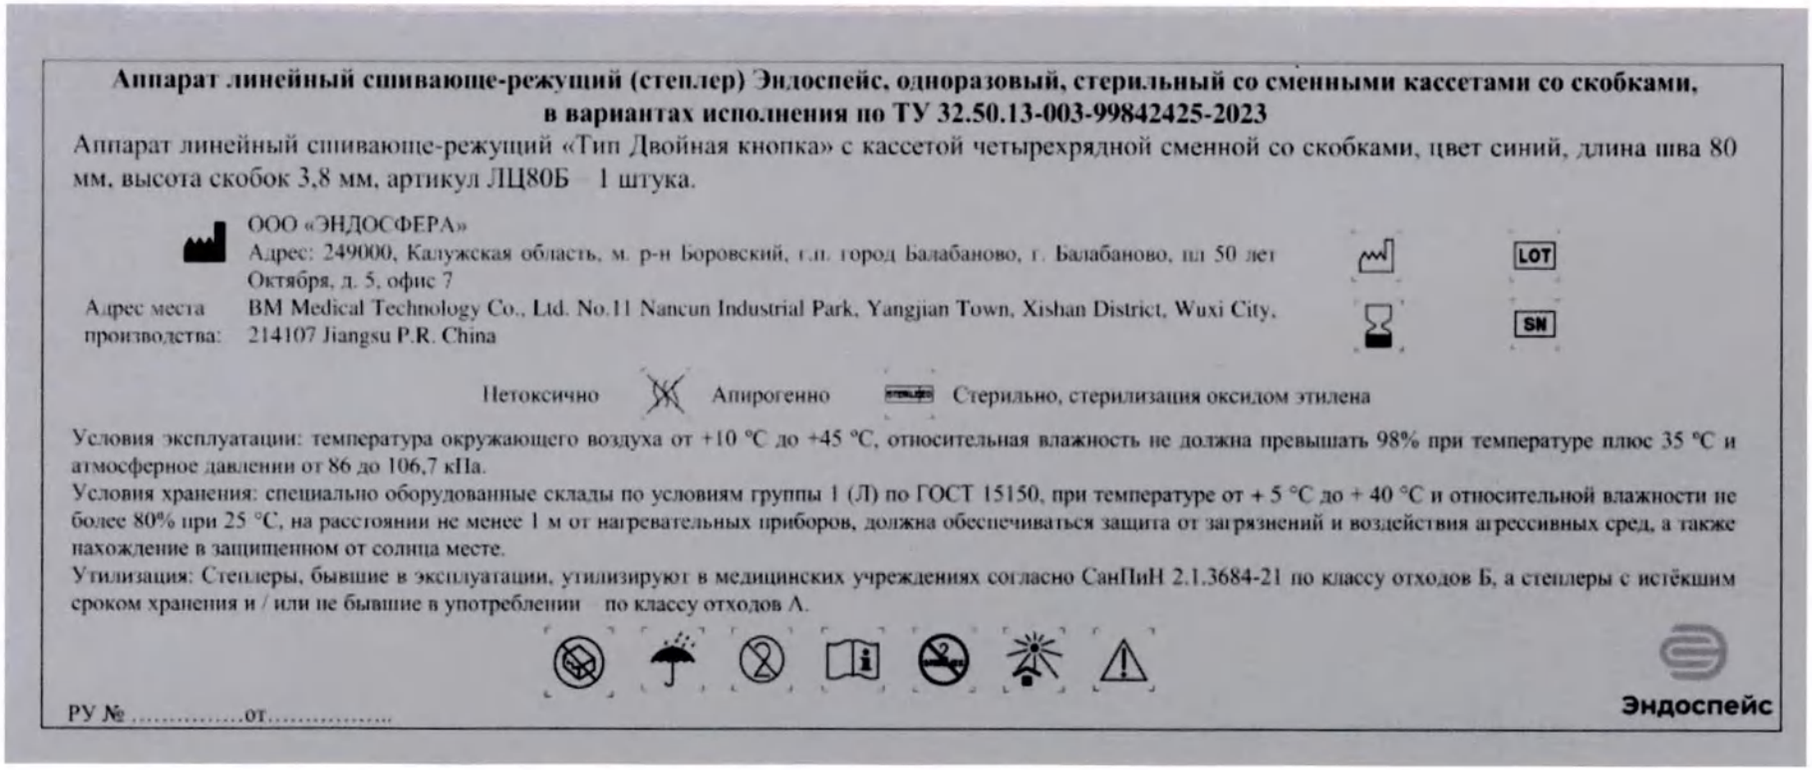

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 26А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

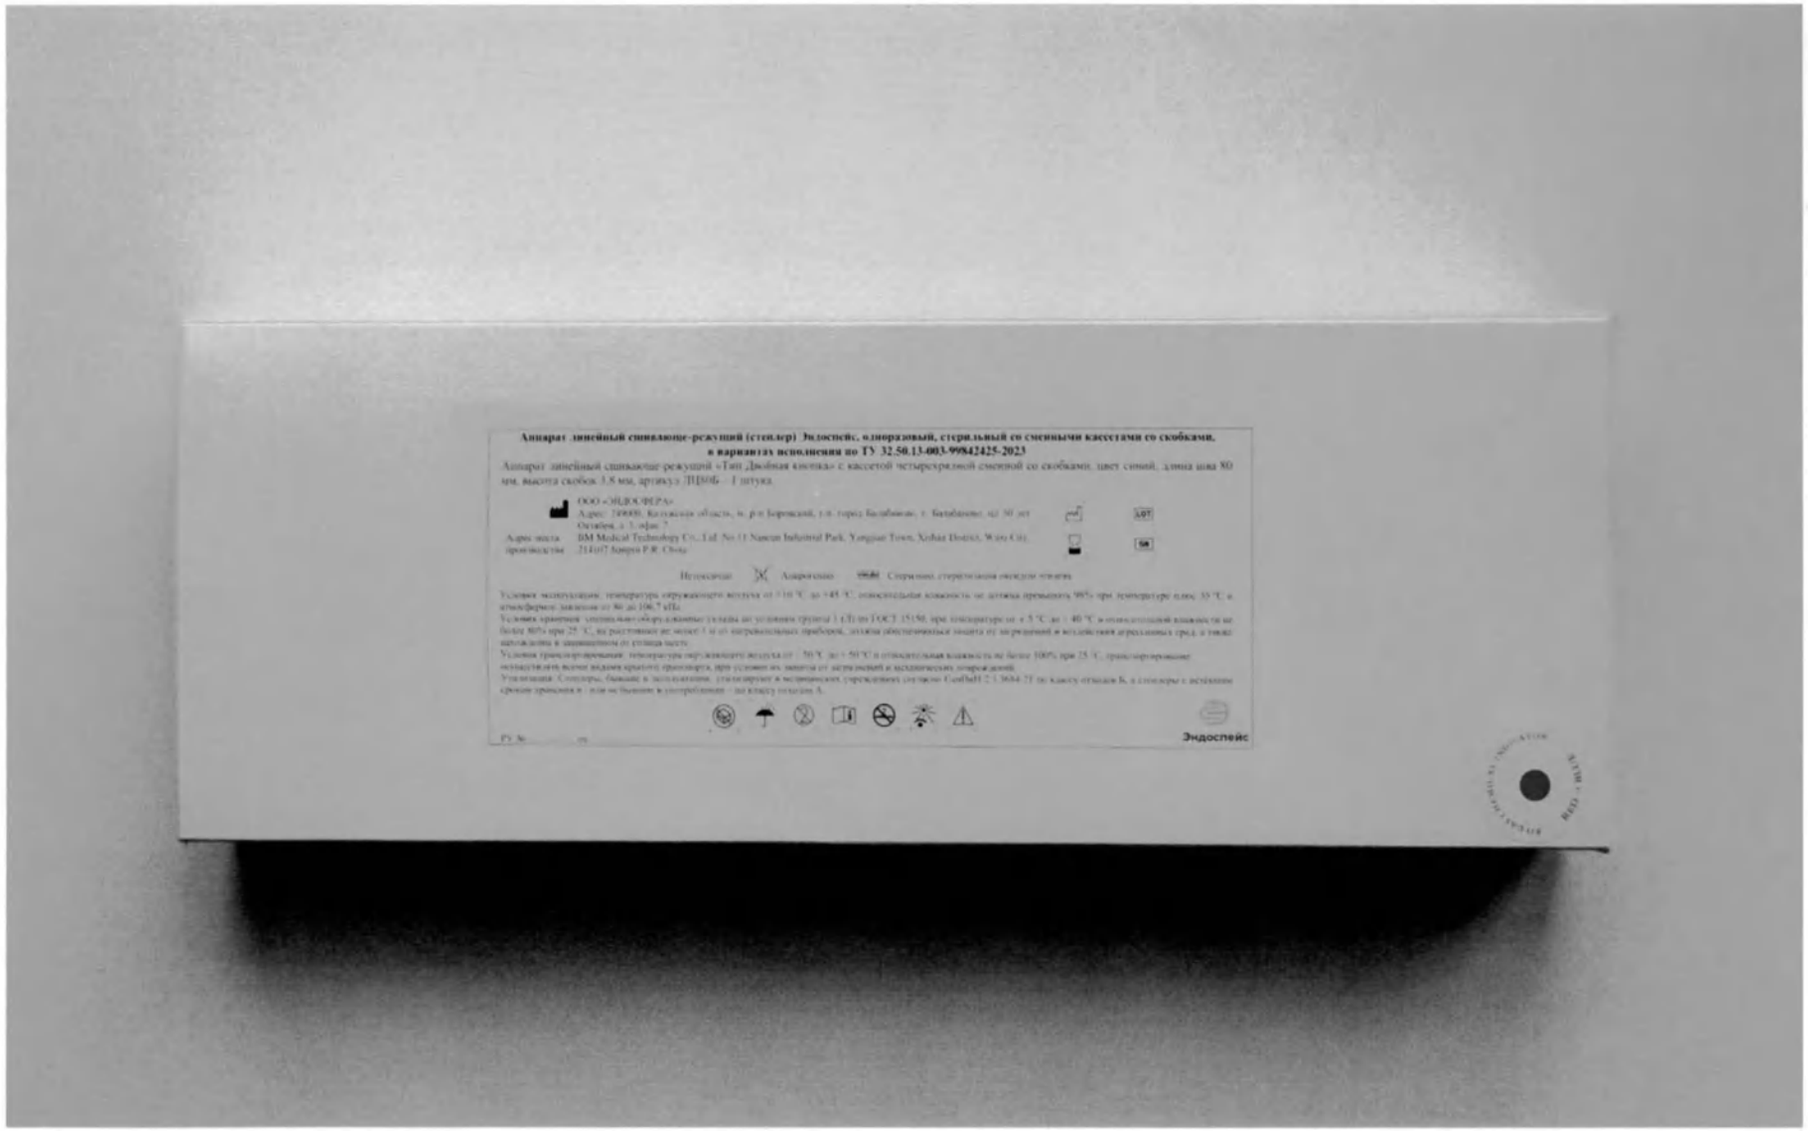

Рисунок 27 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 27А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 28 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 28А – Маркировка индивидуальной упаковки с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

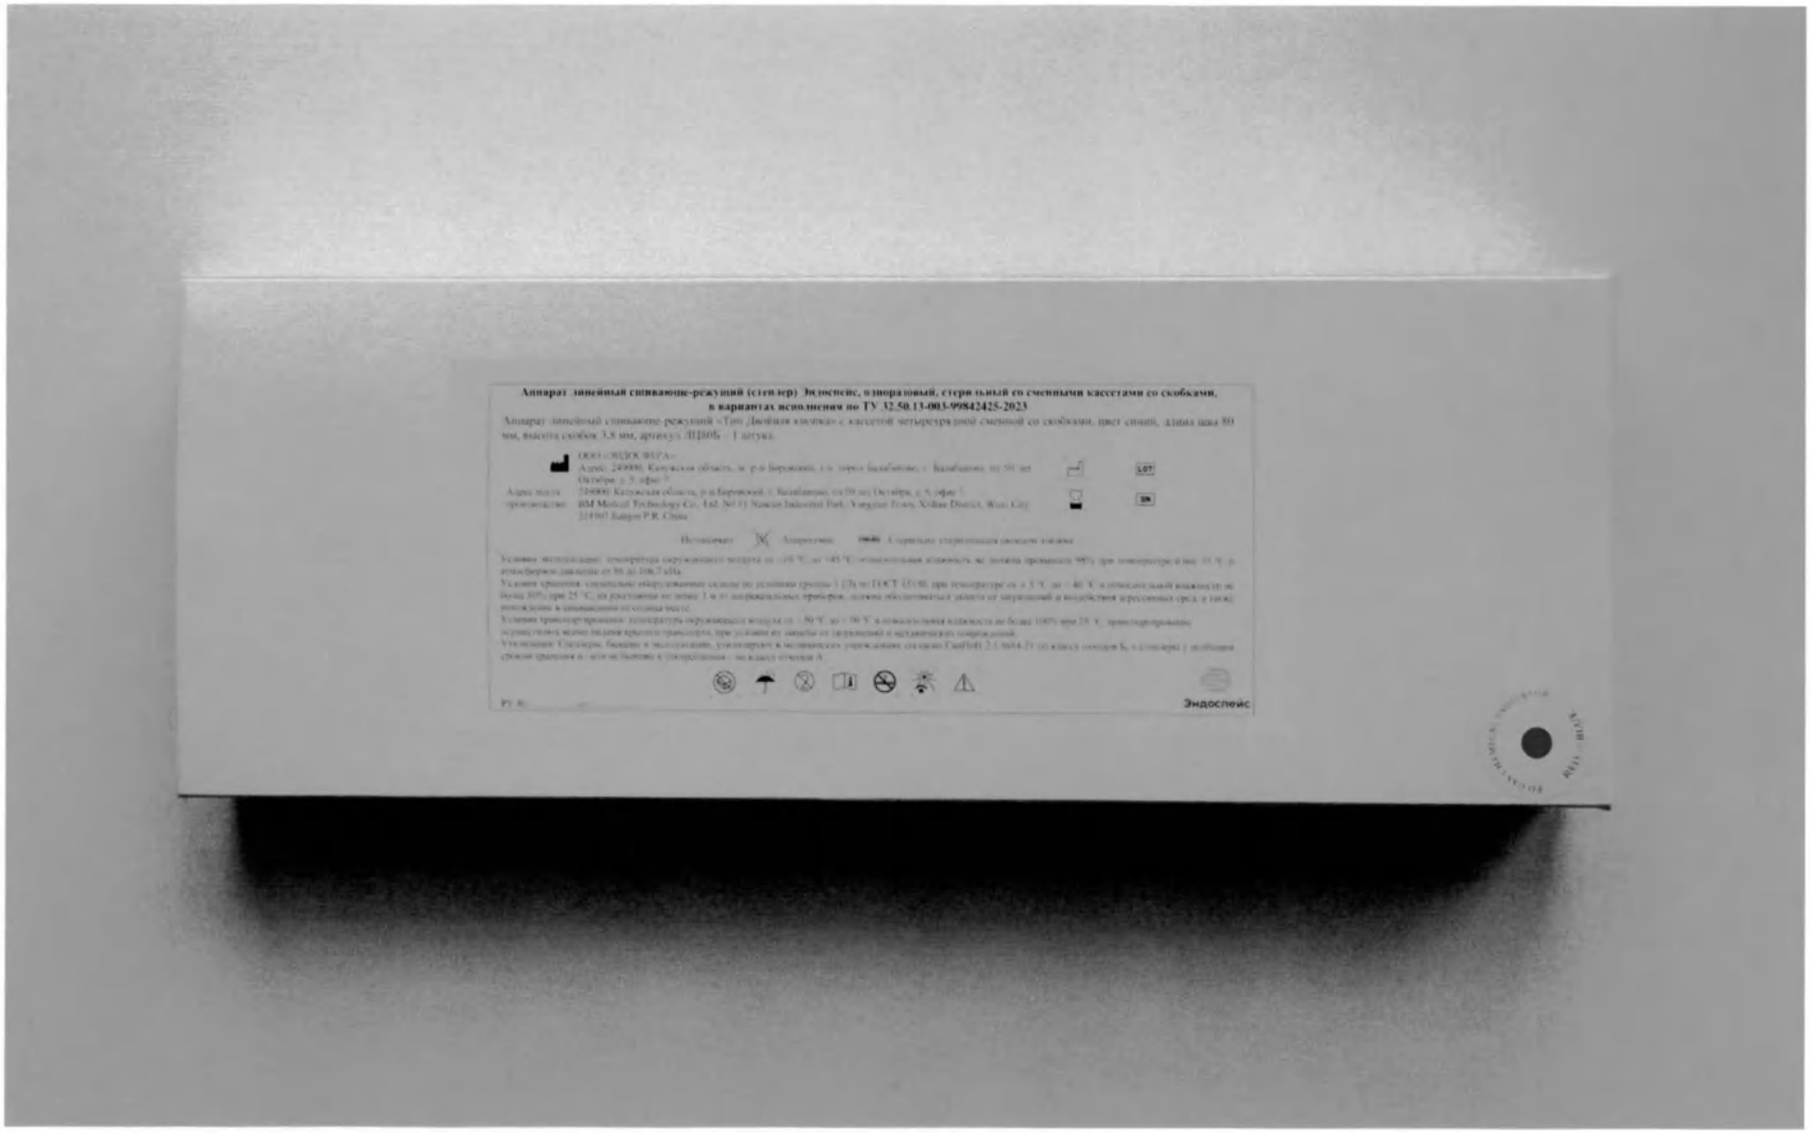

Рисунок 29 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

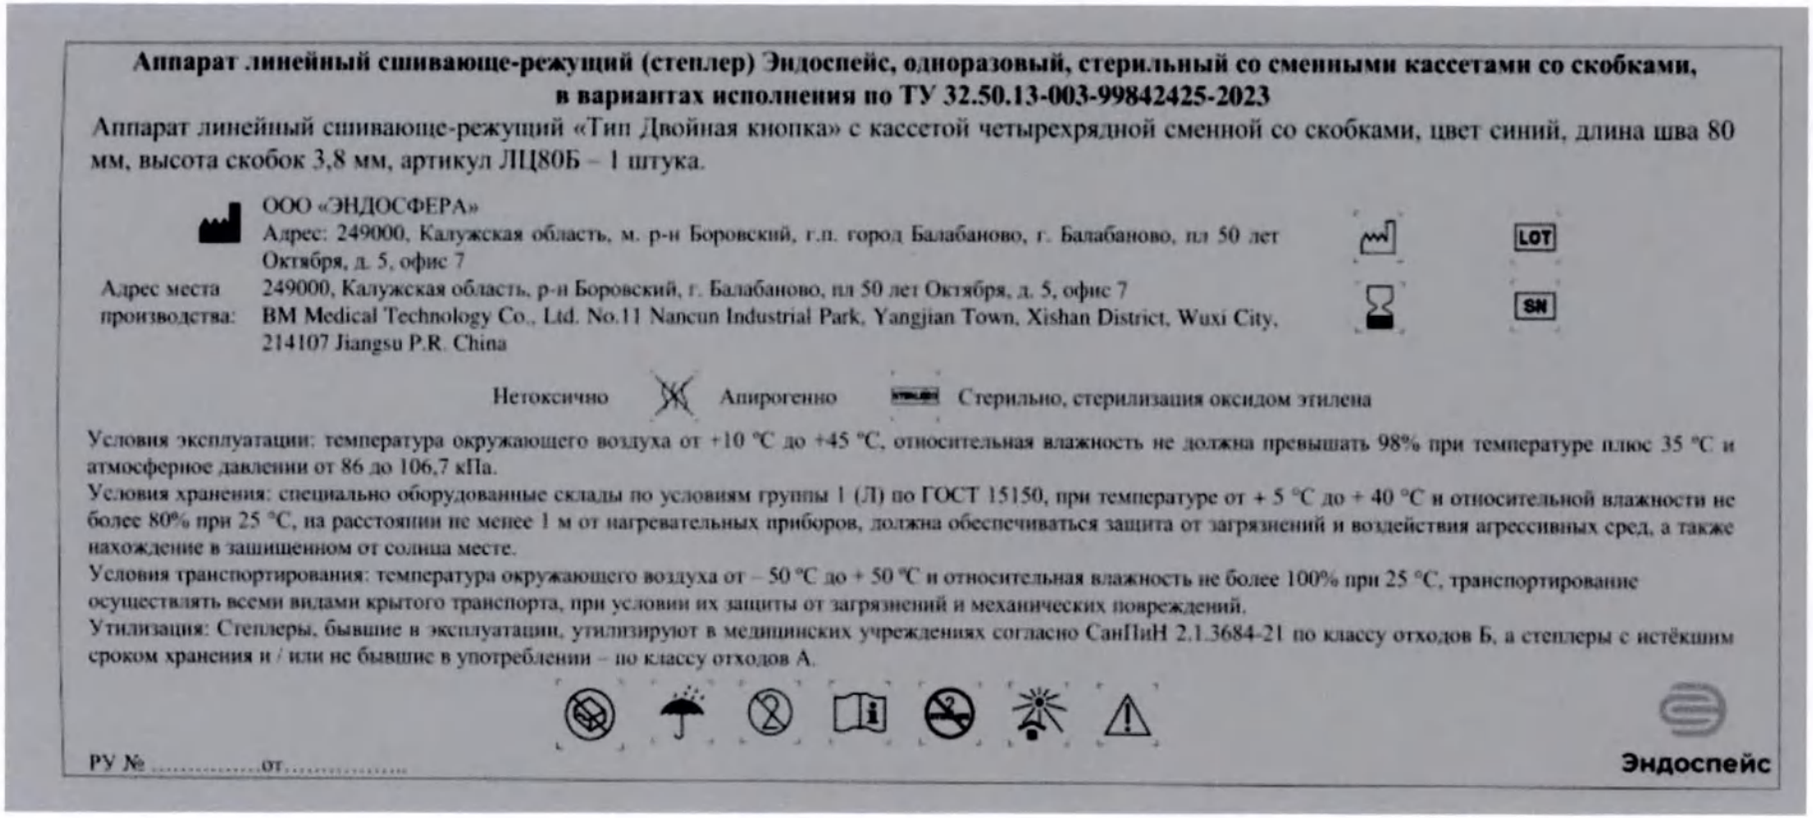

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 29А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 30 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

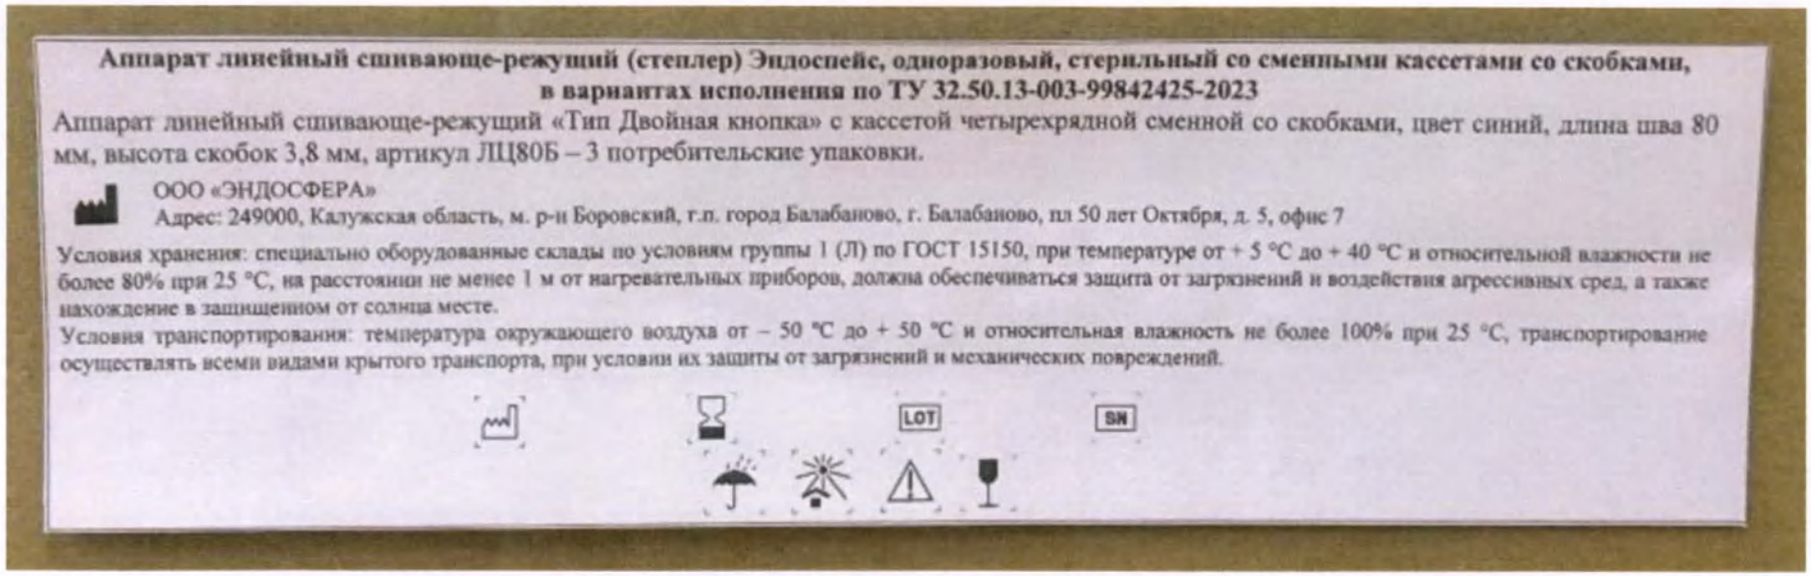

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 30А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

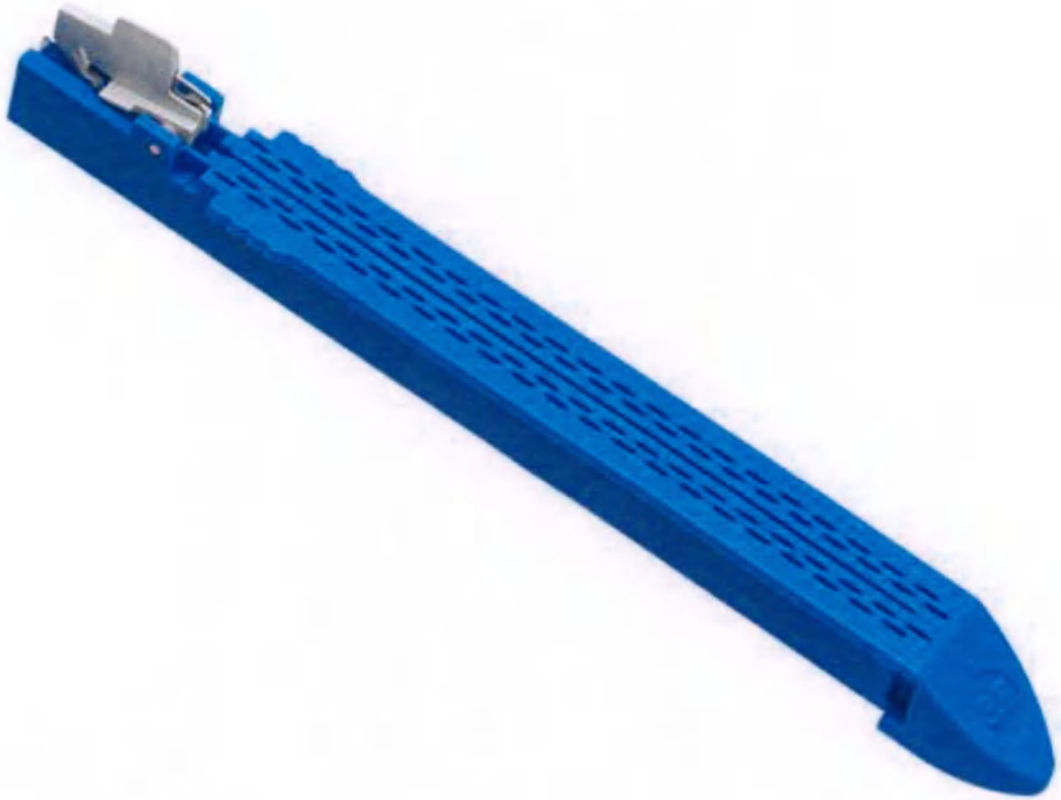

Рисунок 31 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 32 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 32А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

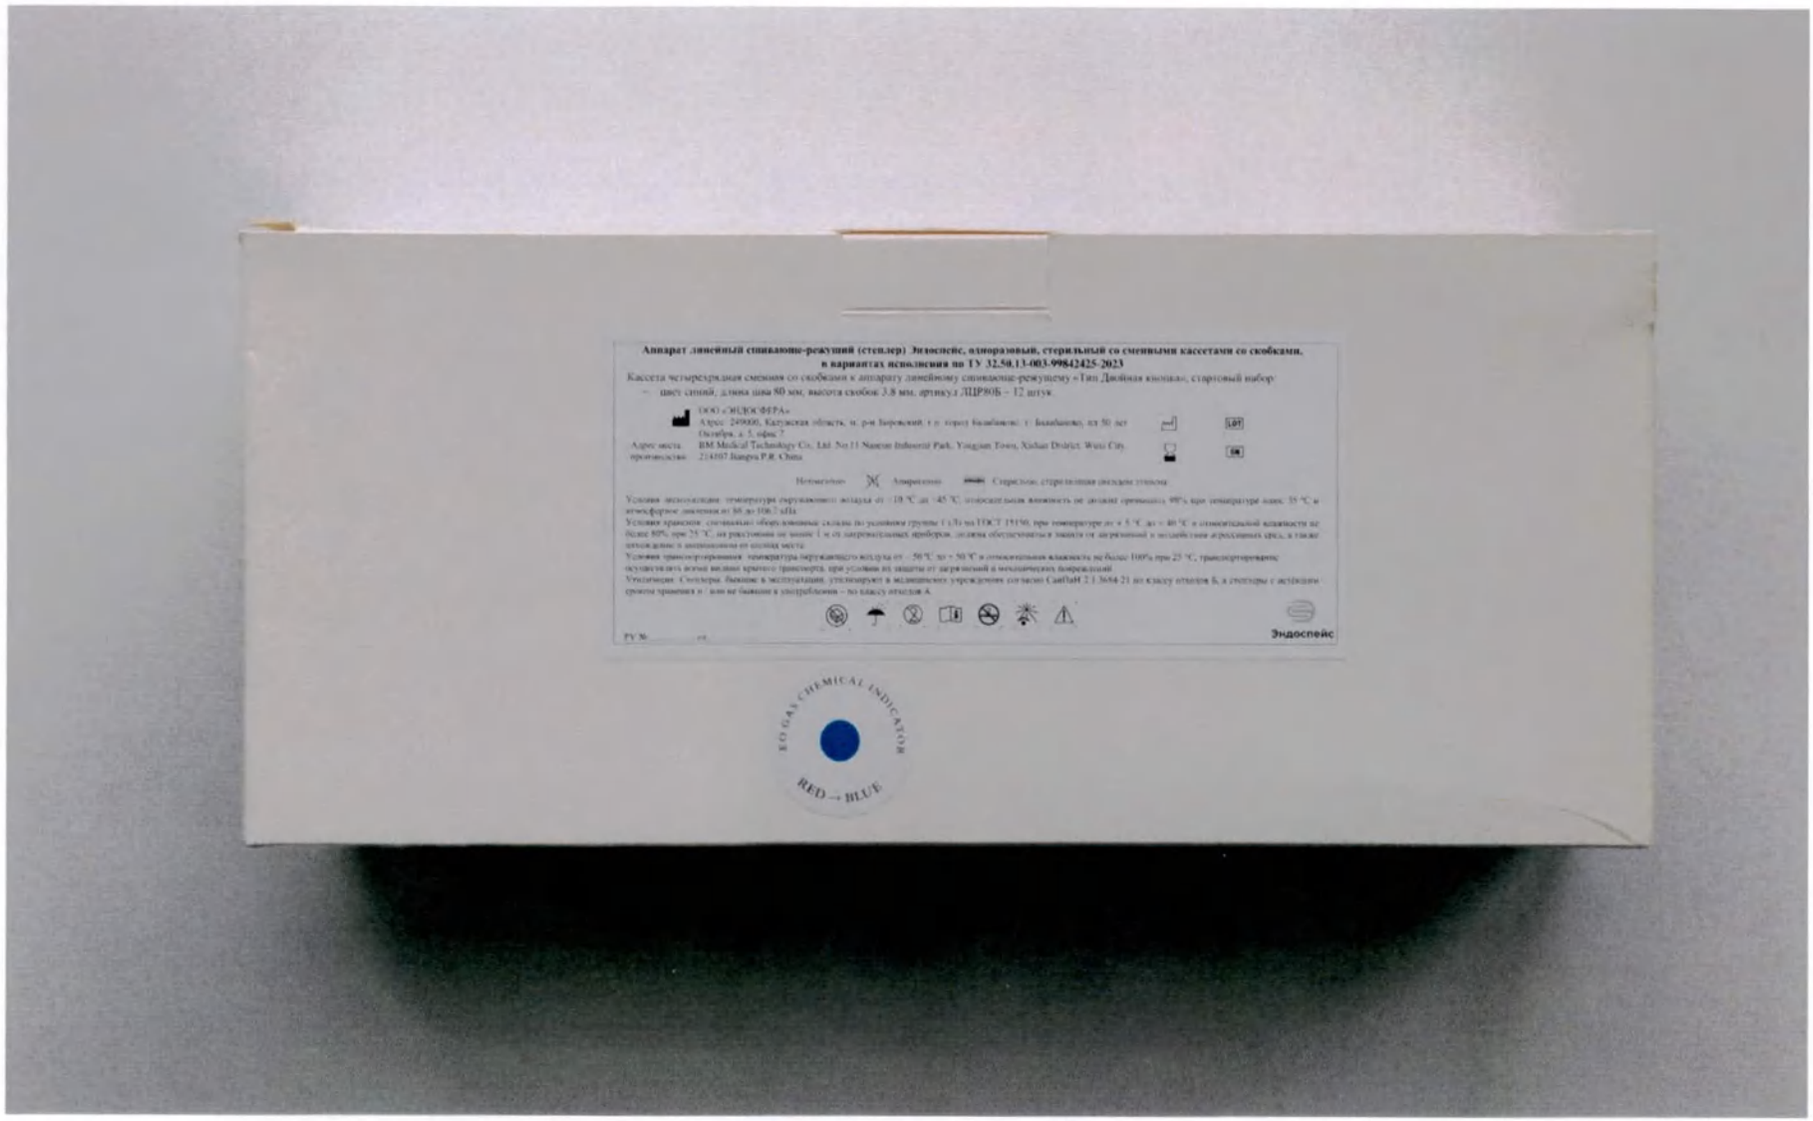

Рисунок 33 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

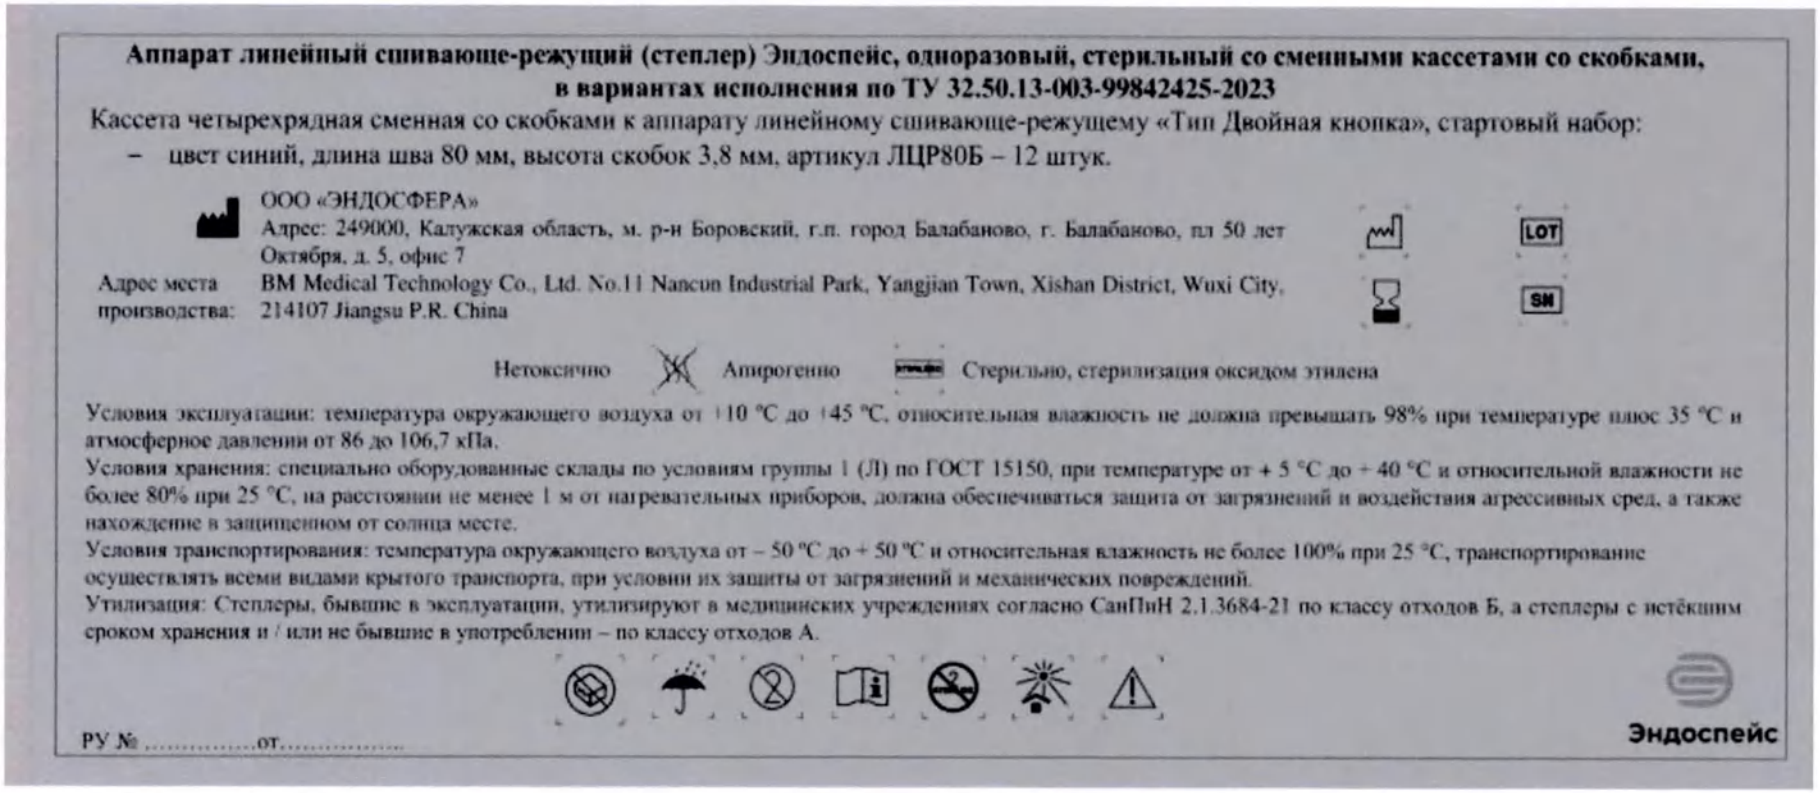

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 33А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 34 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 34А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 35 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

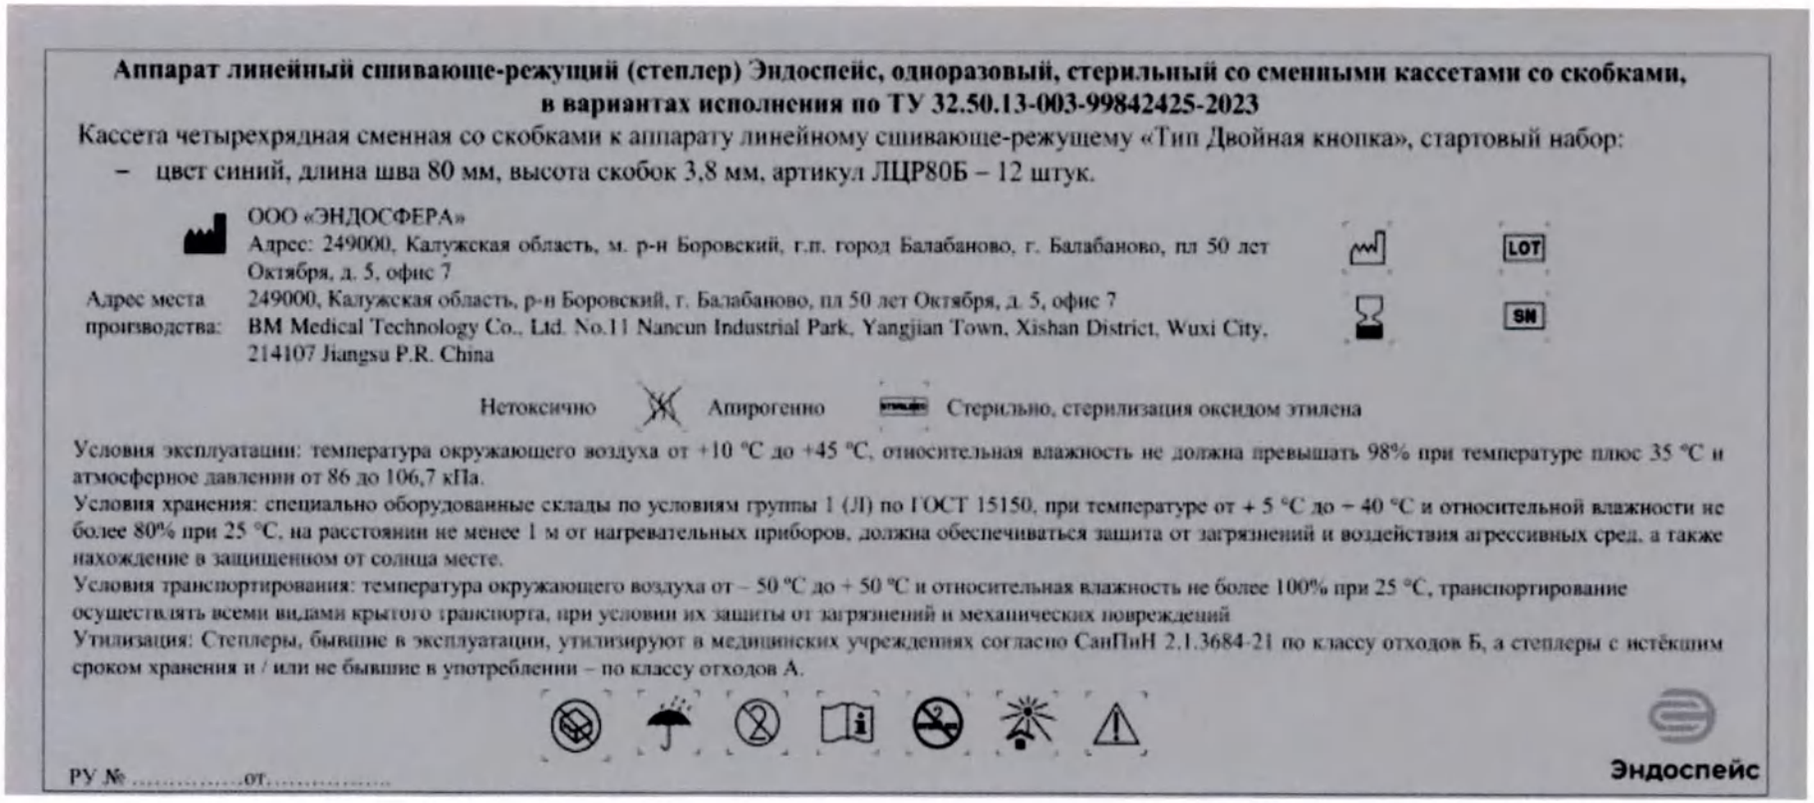

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 35А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

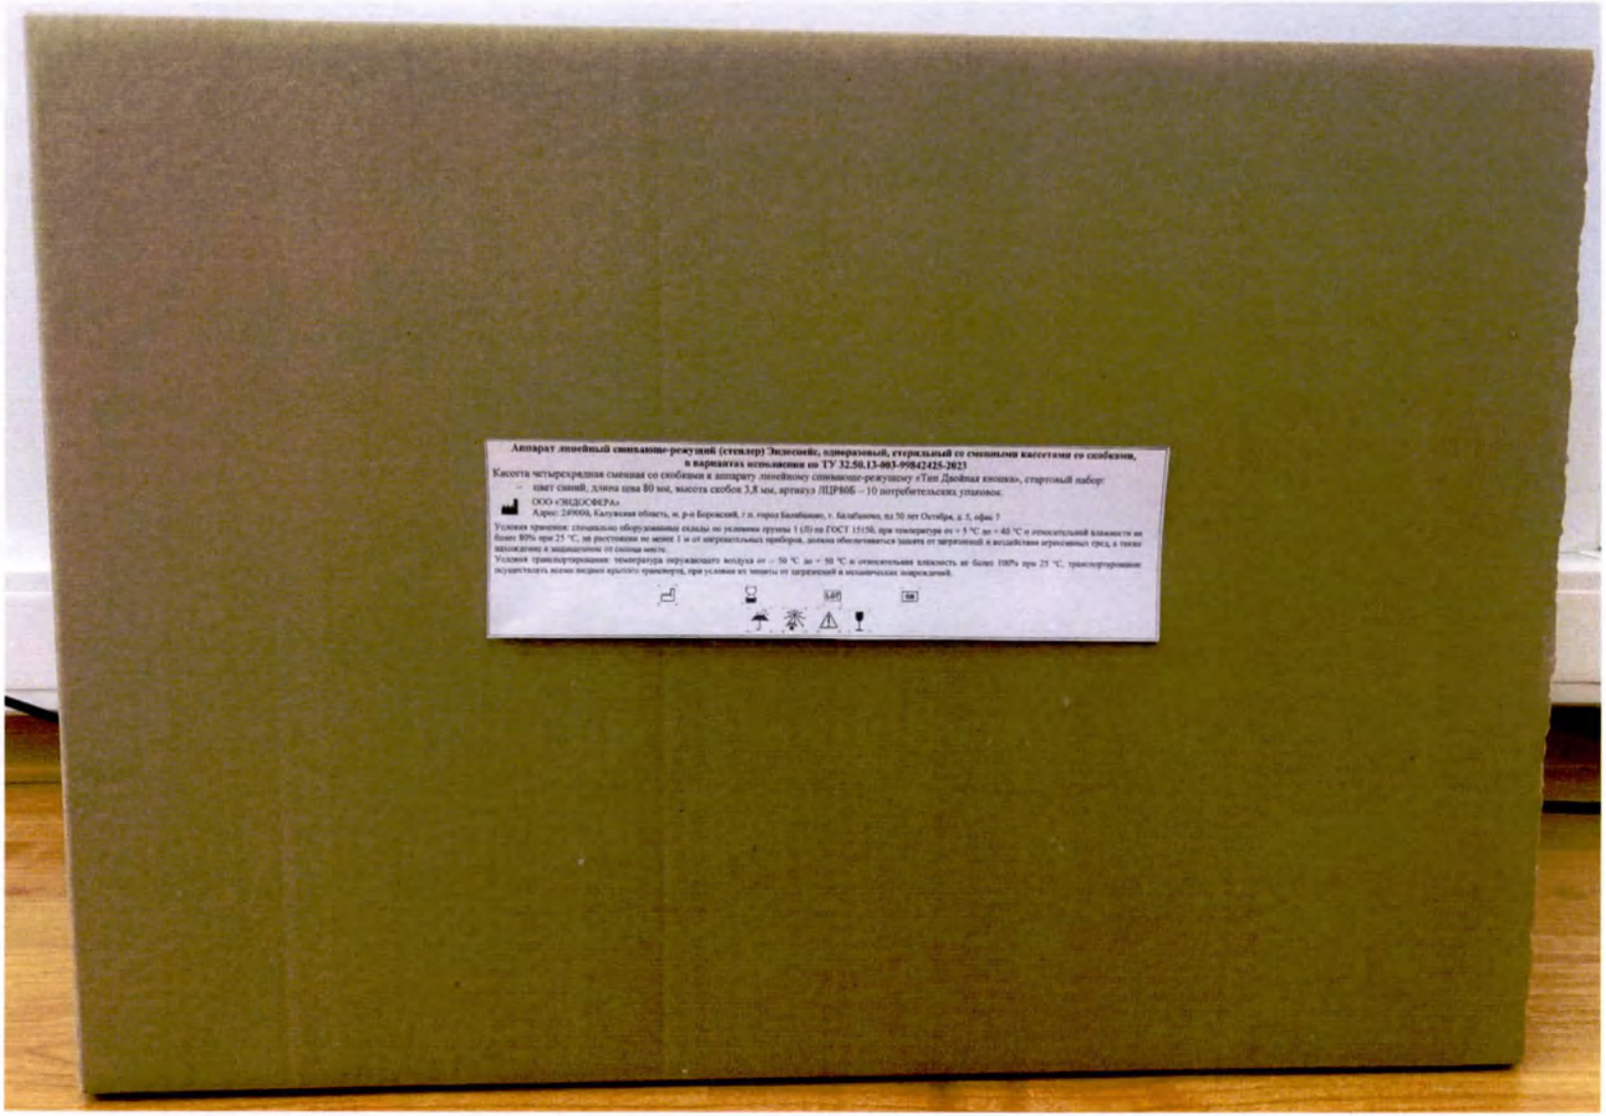

Рисунок 36 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

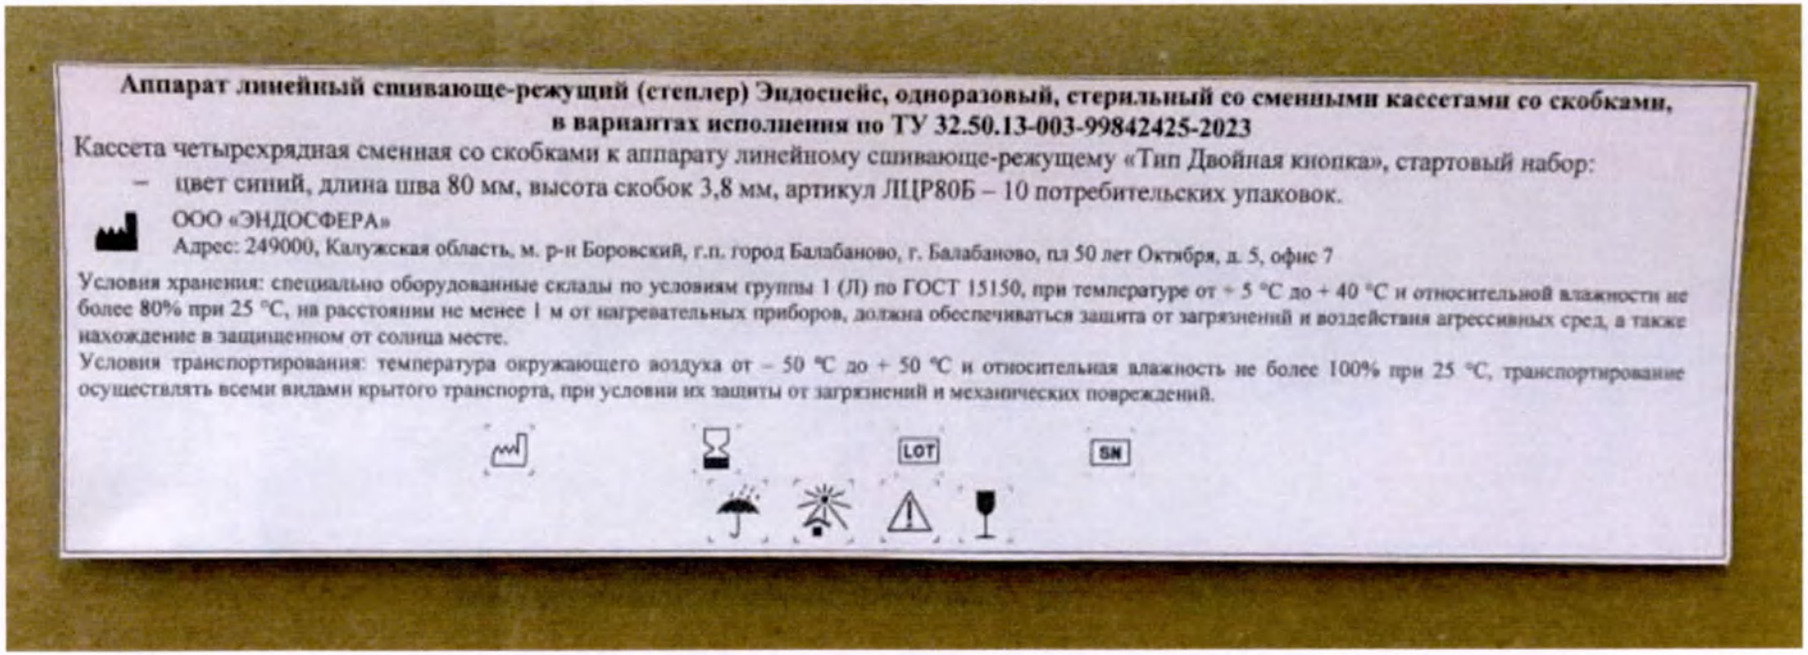

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 36А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 80 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

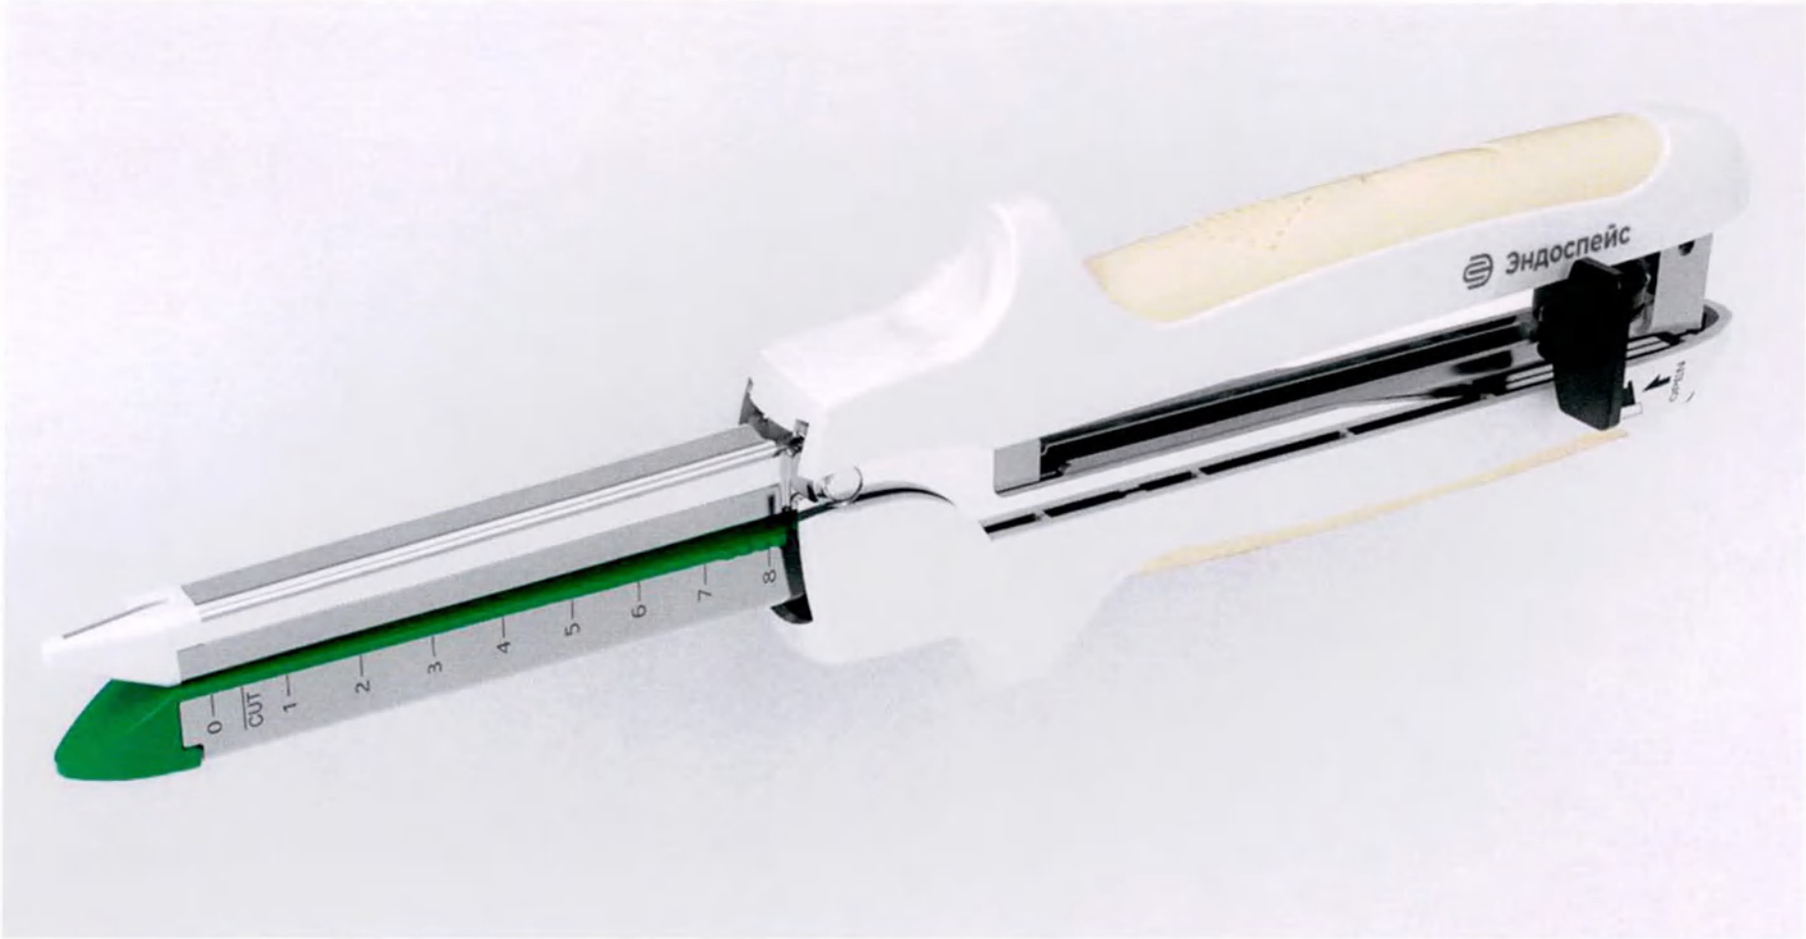

Рисунок 37 – Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 38 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

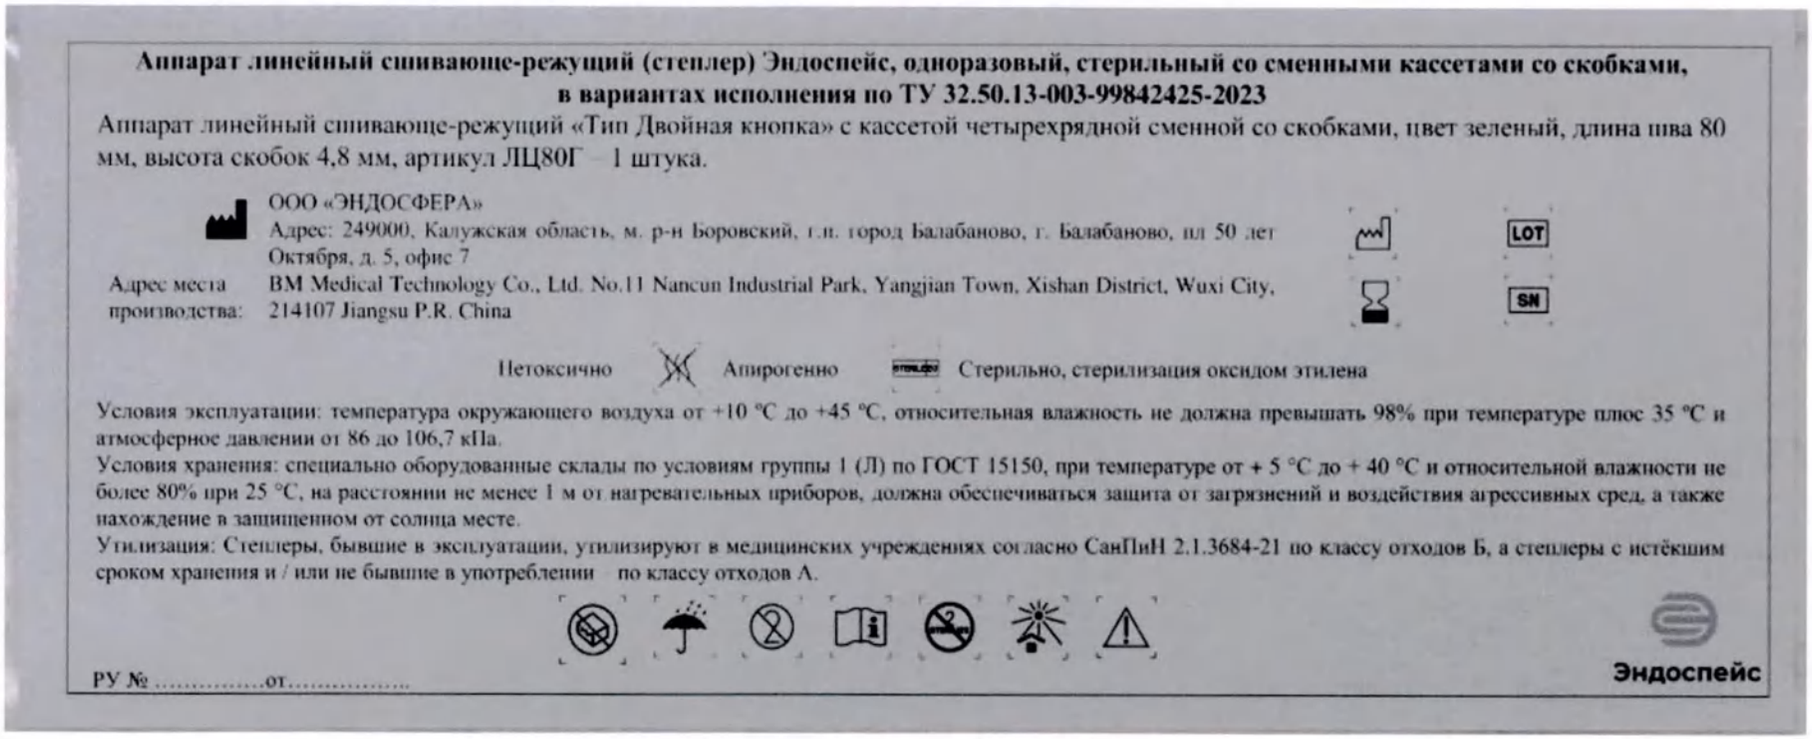

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 38А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

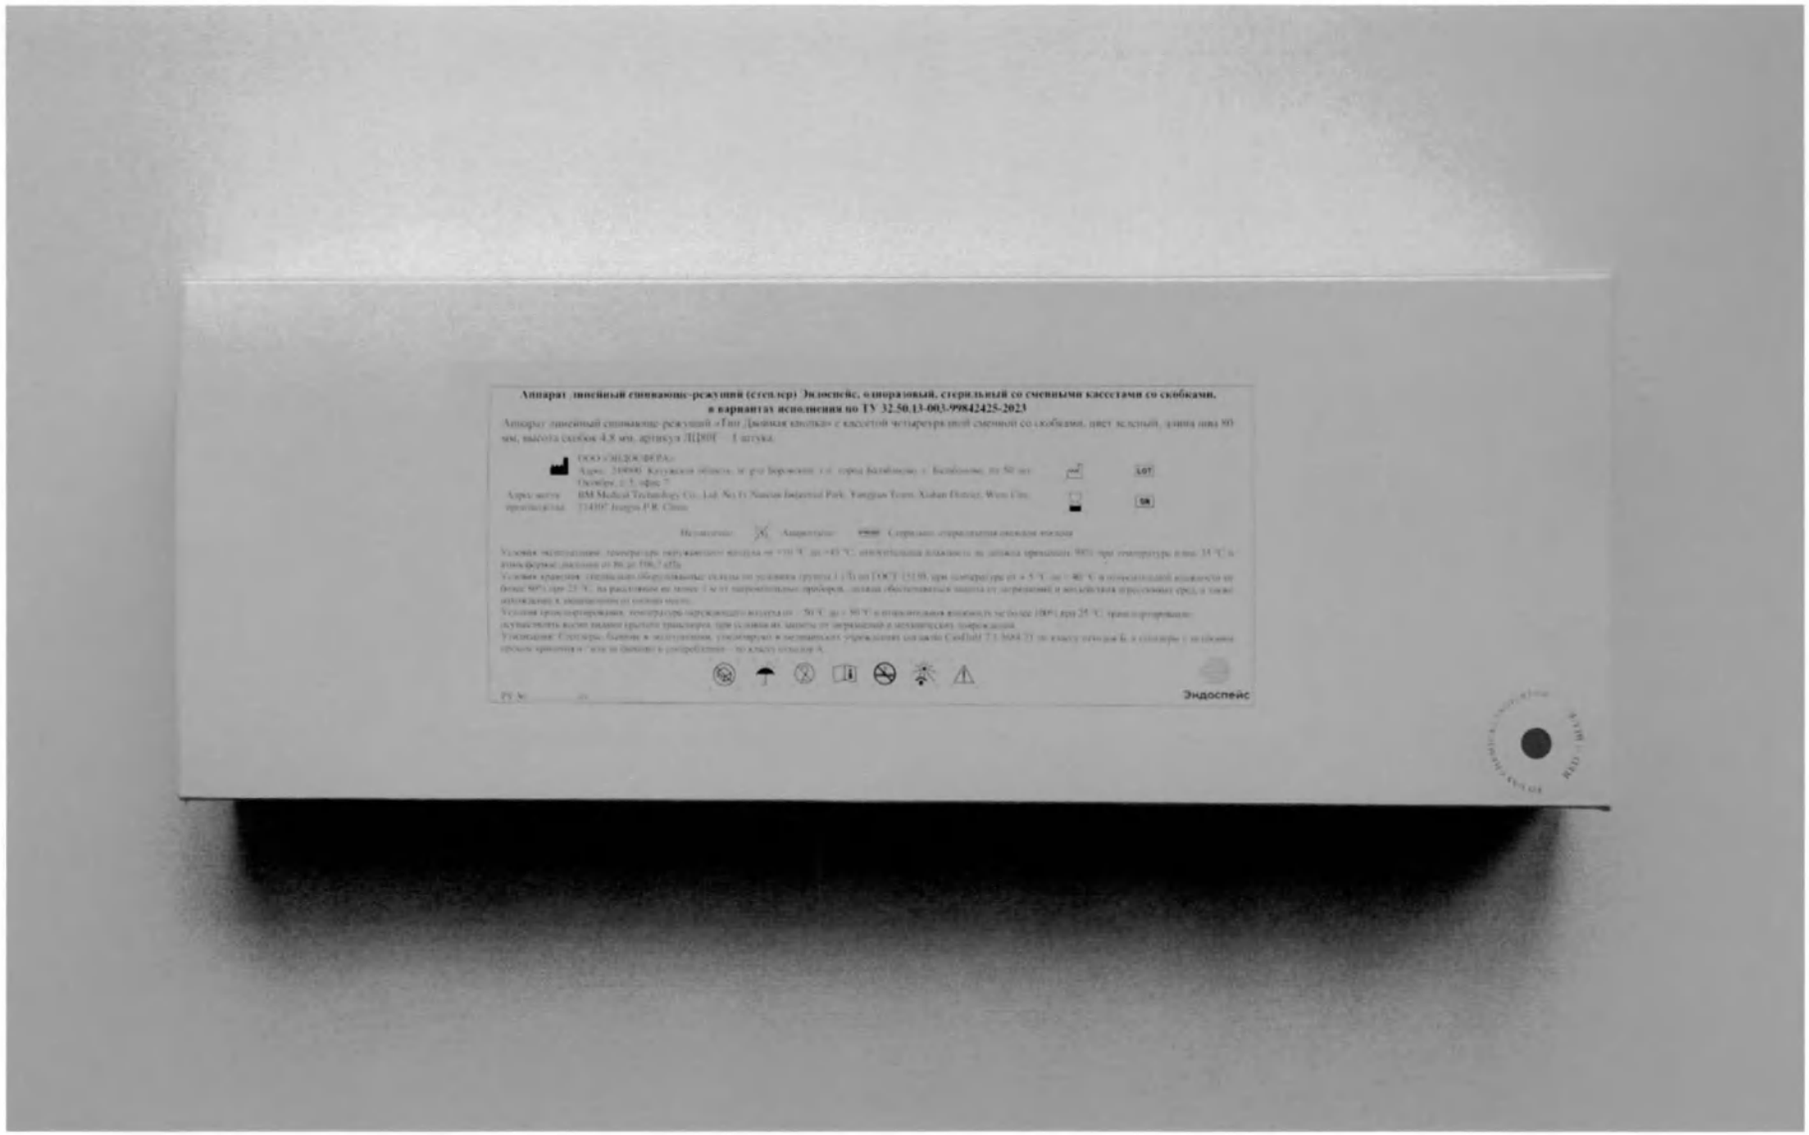

Рисунок 39 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

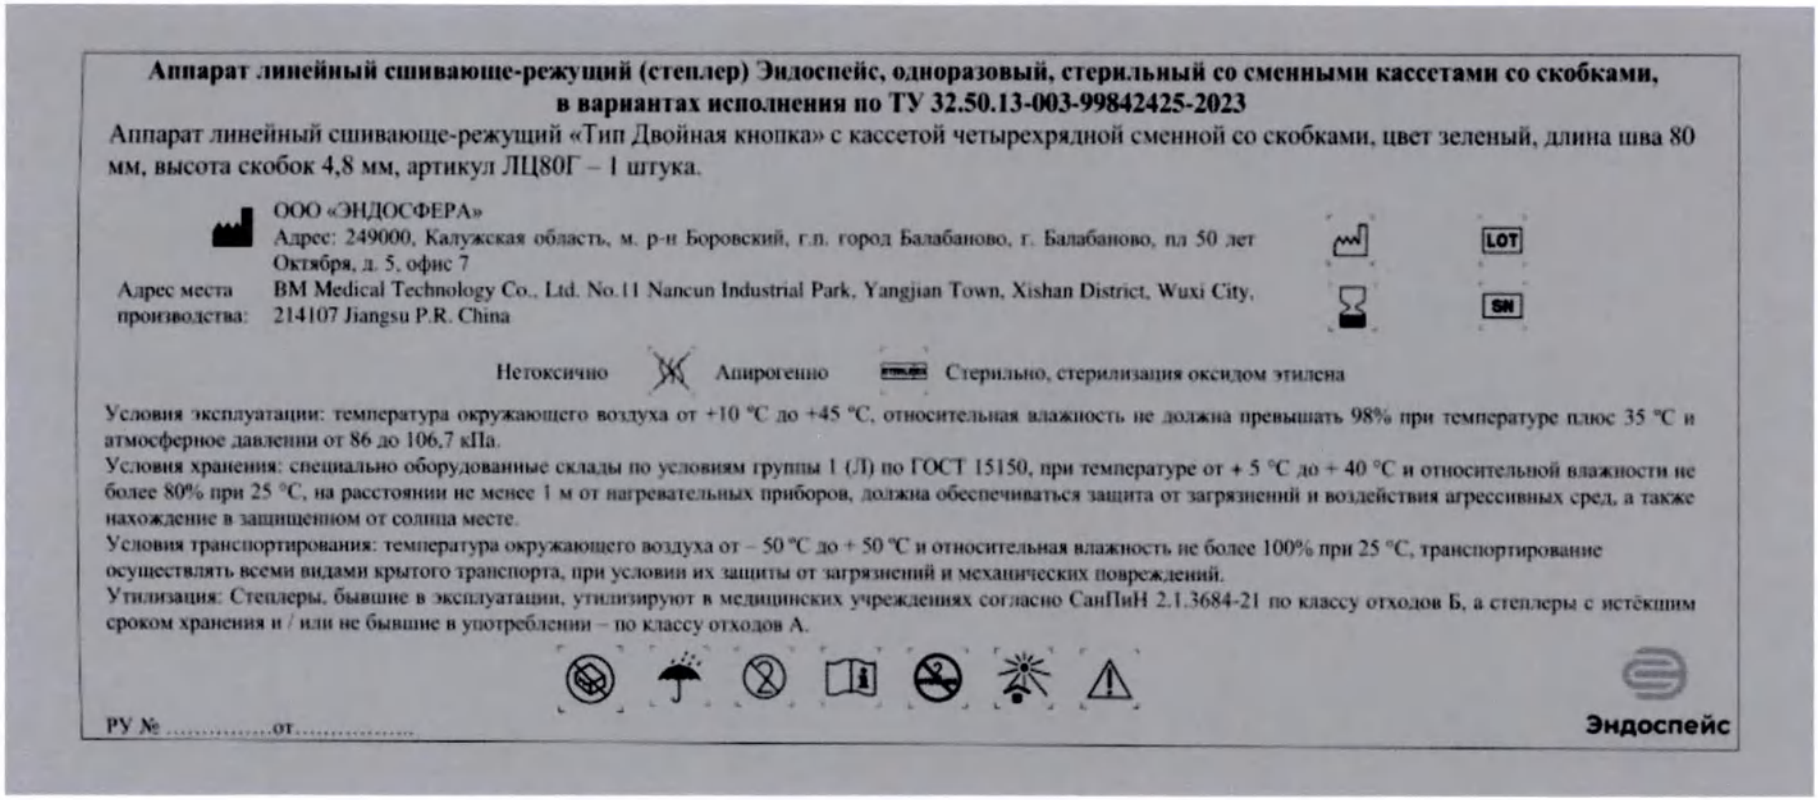

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 39А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 40 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

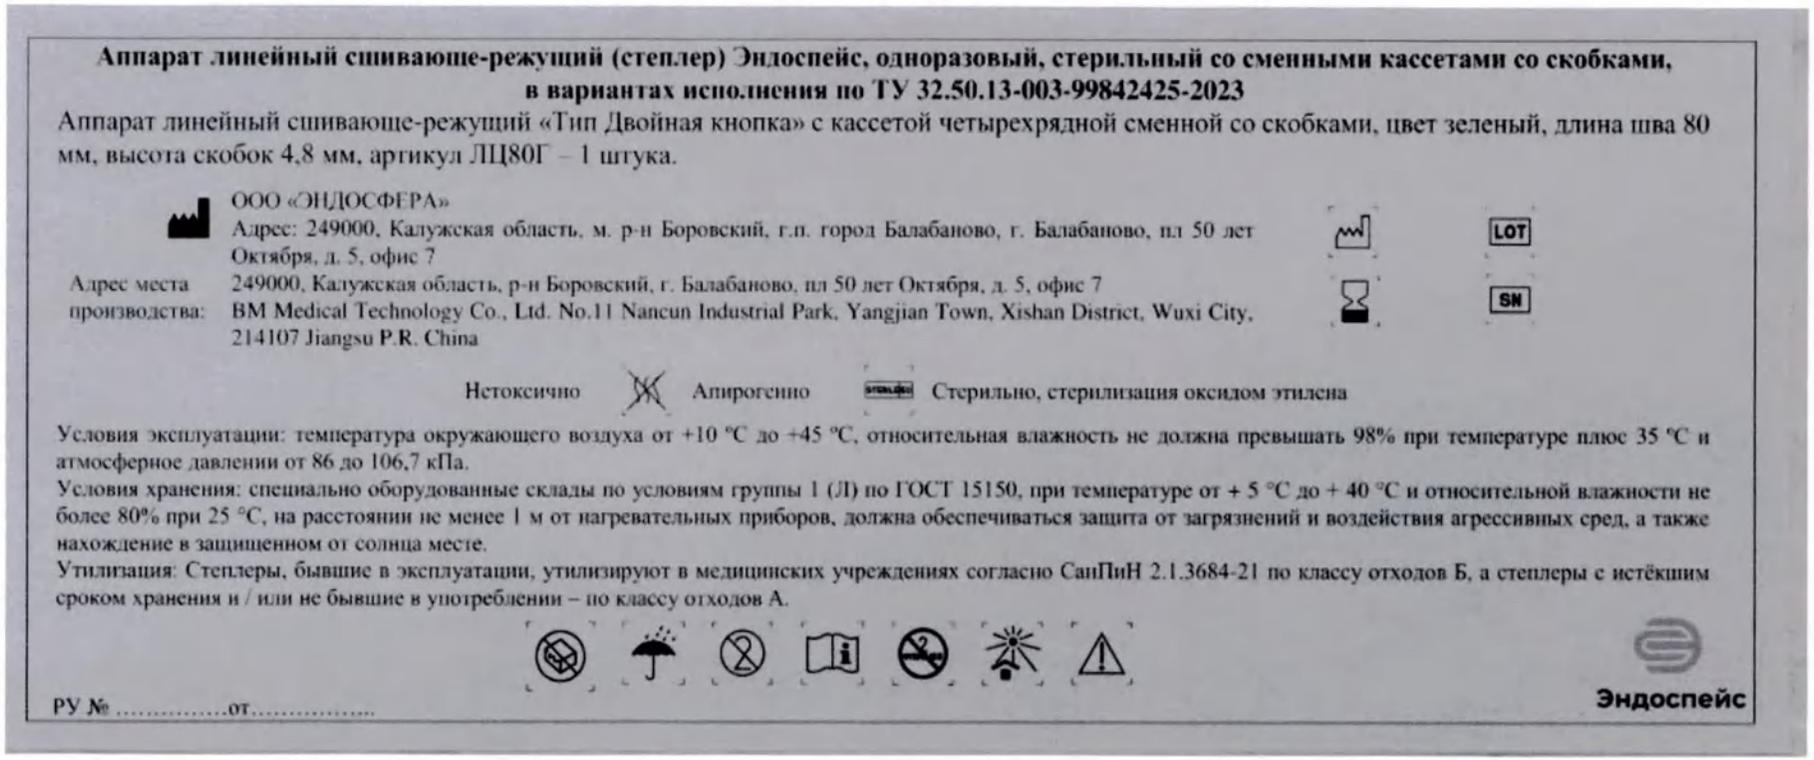

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 40А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

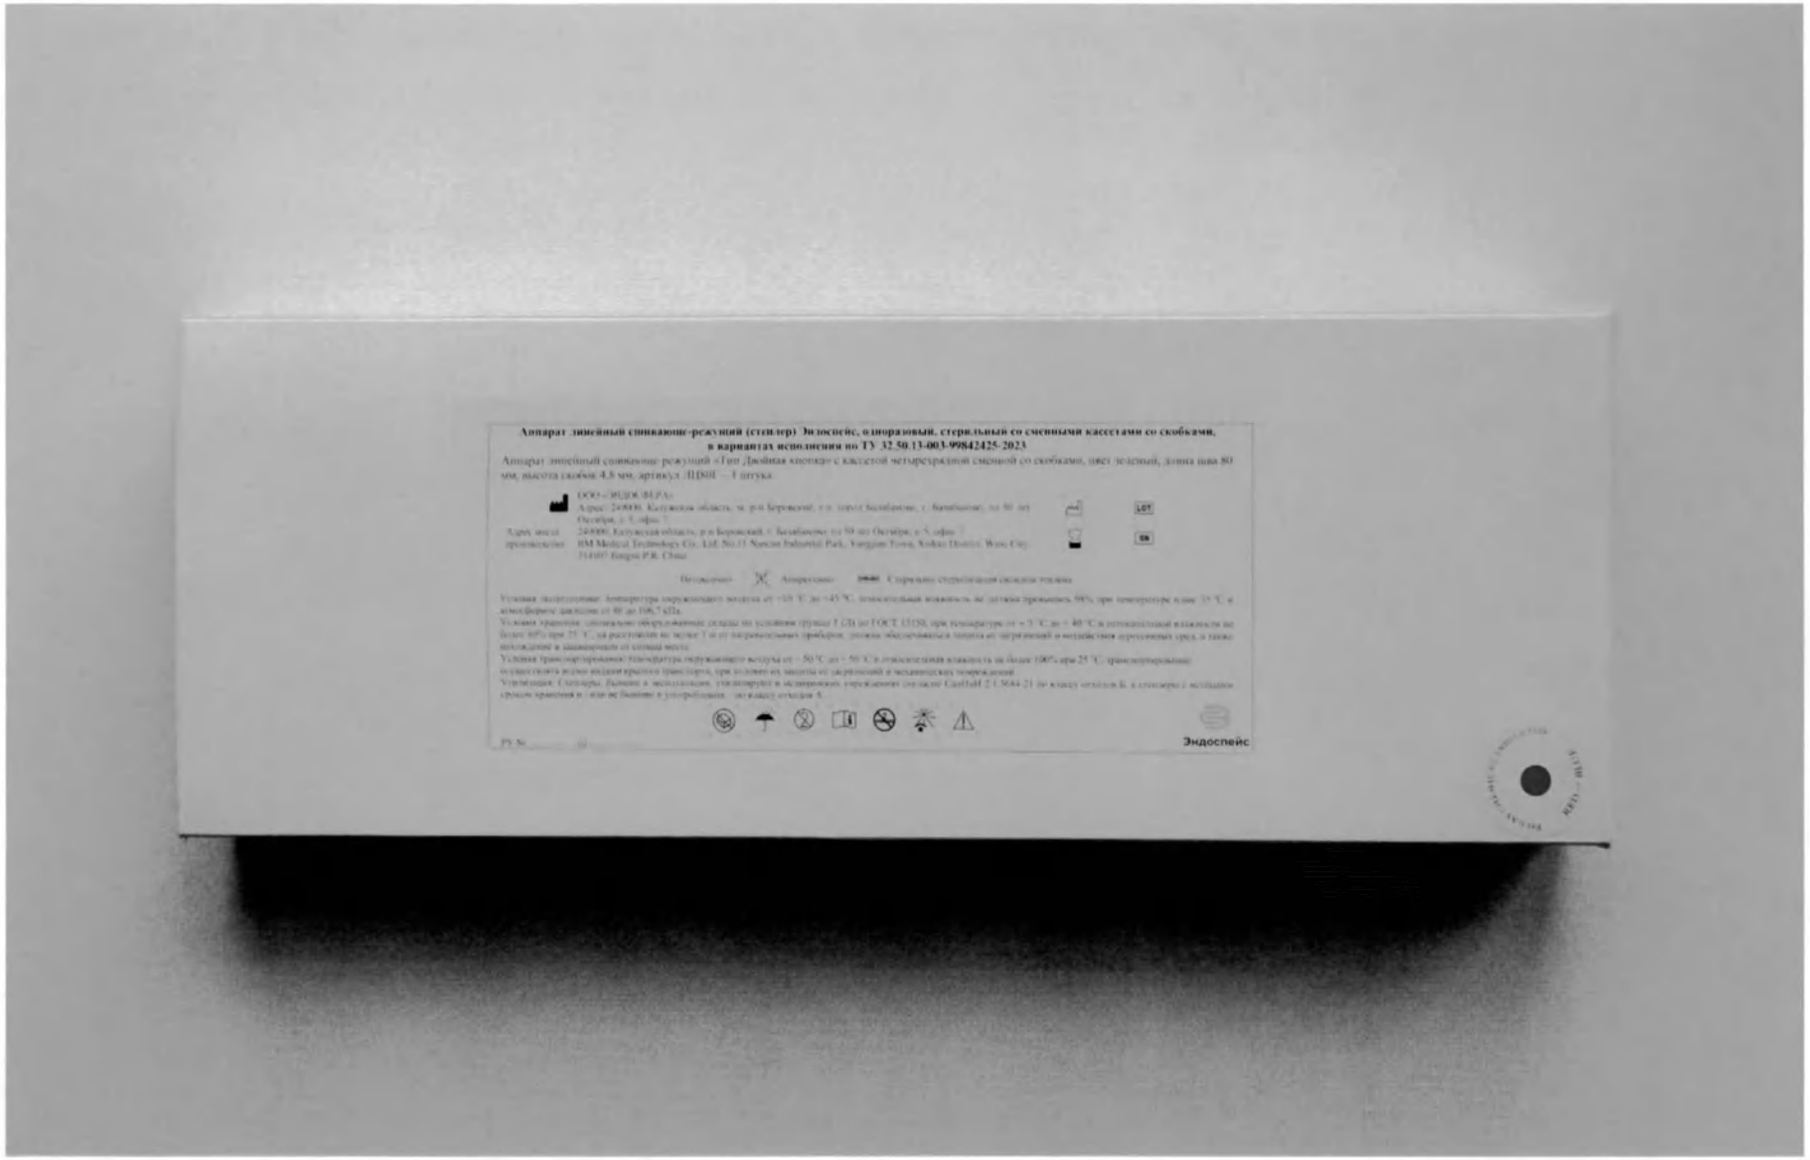

Рисунок 41 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

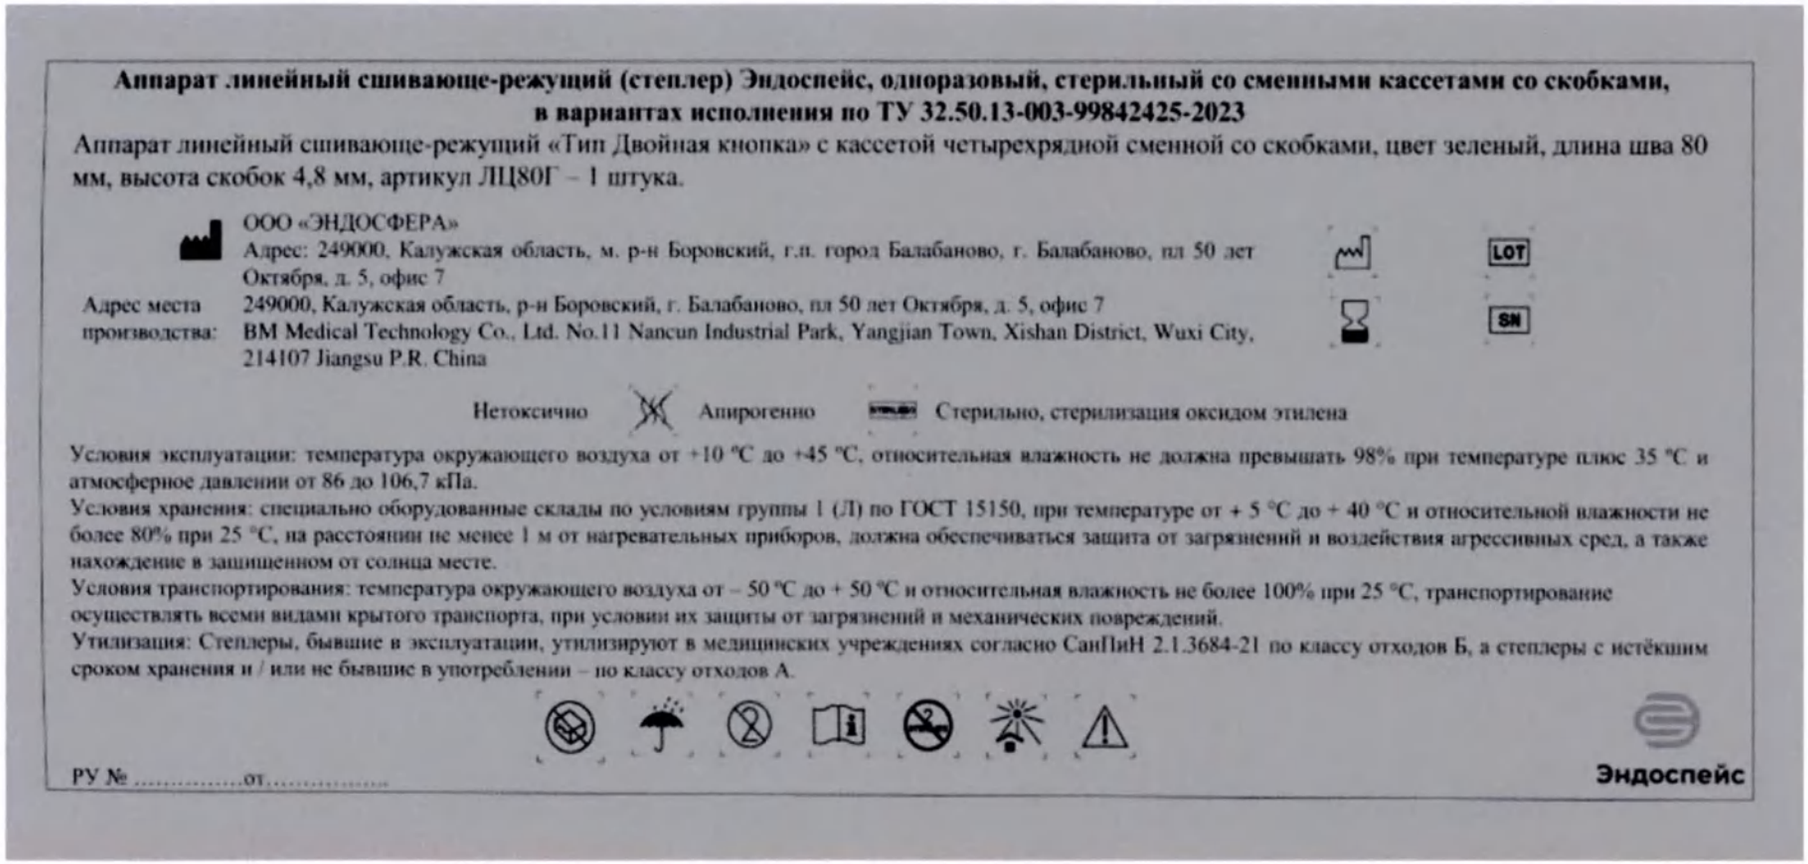

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 41А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 42 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

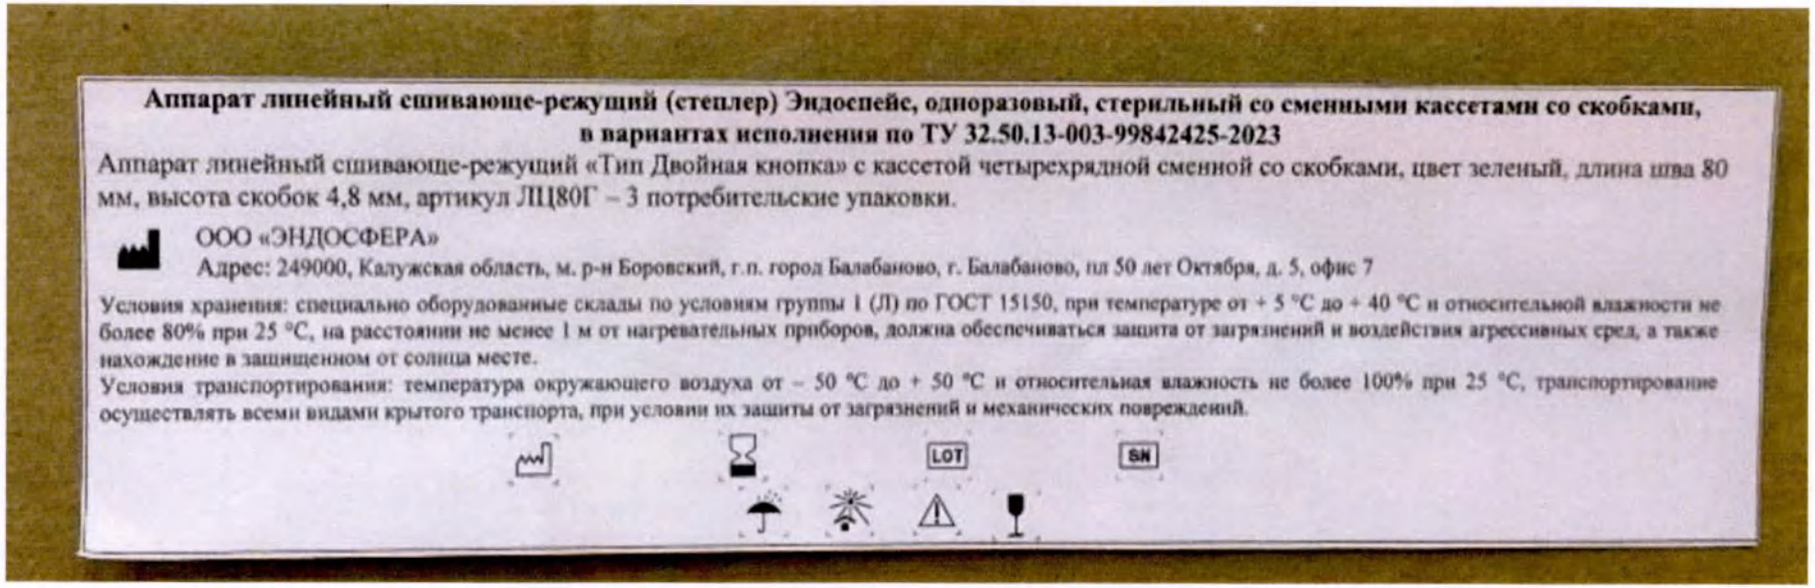

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 42А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 43 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 44 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

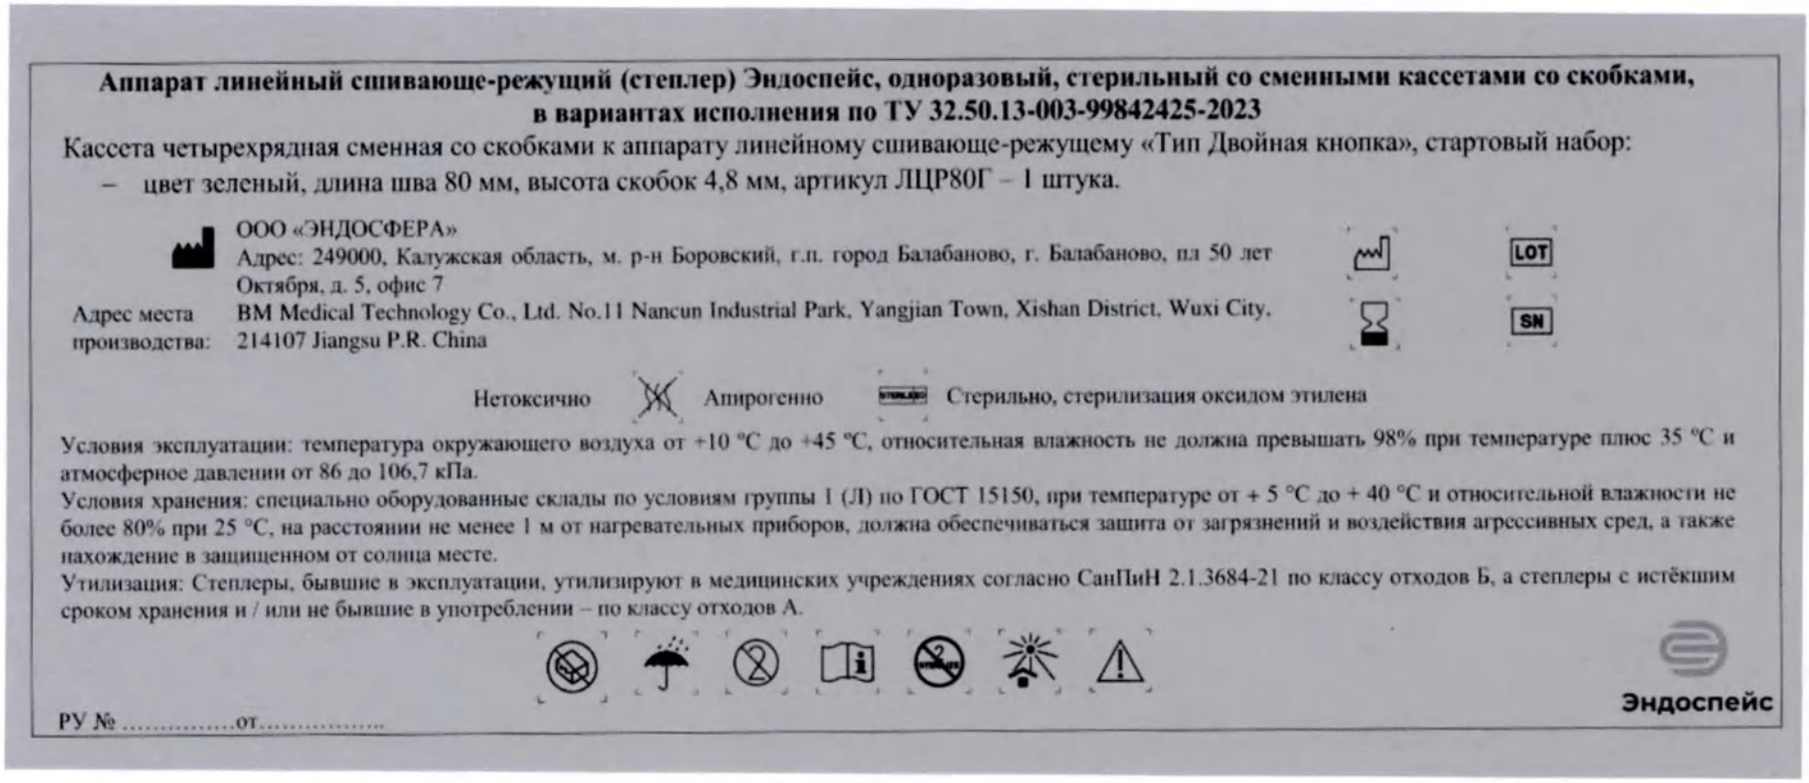

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 44А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

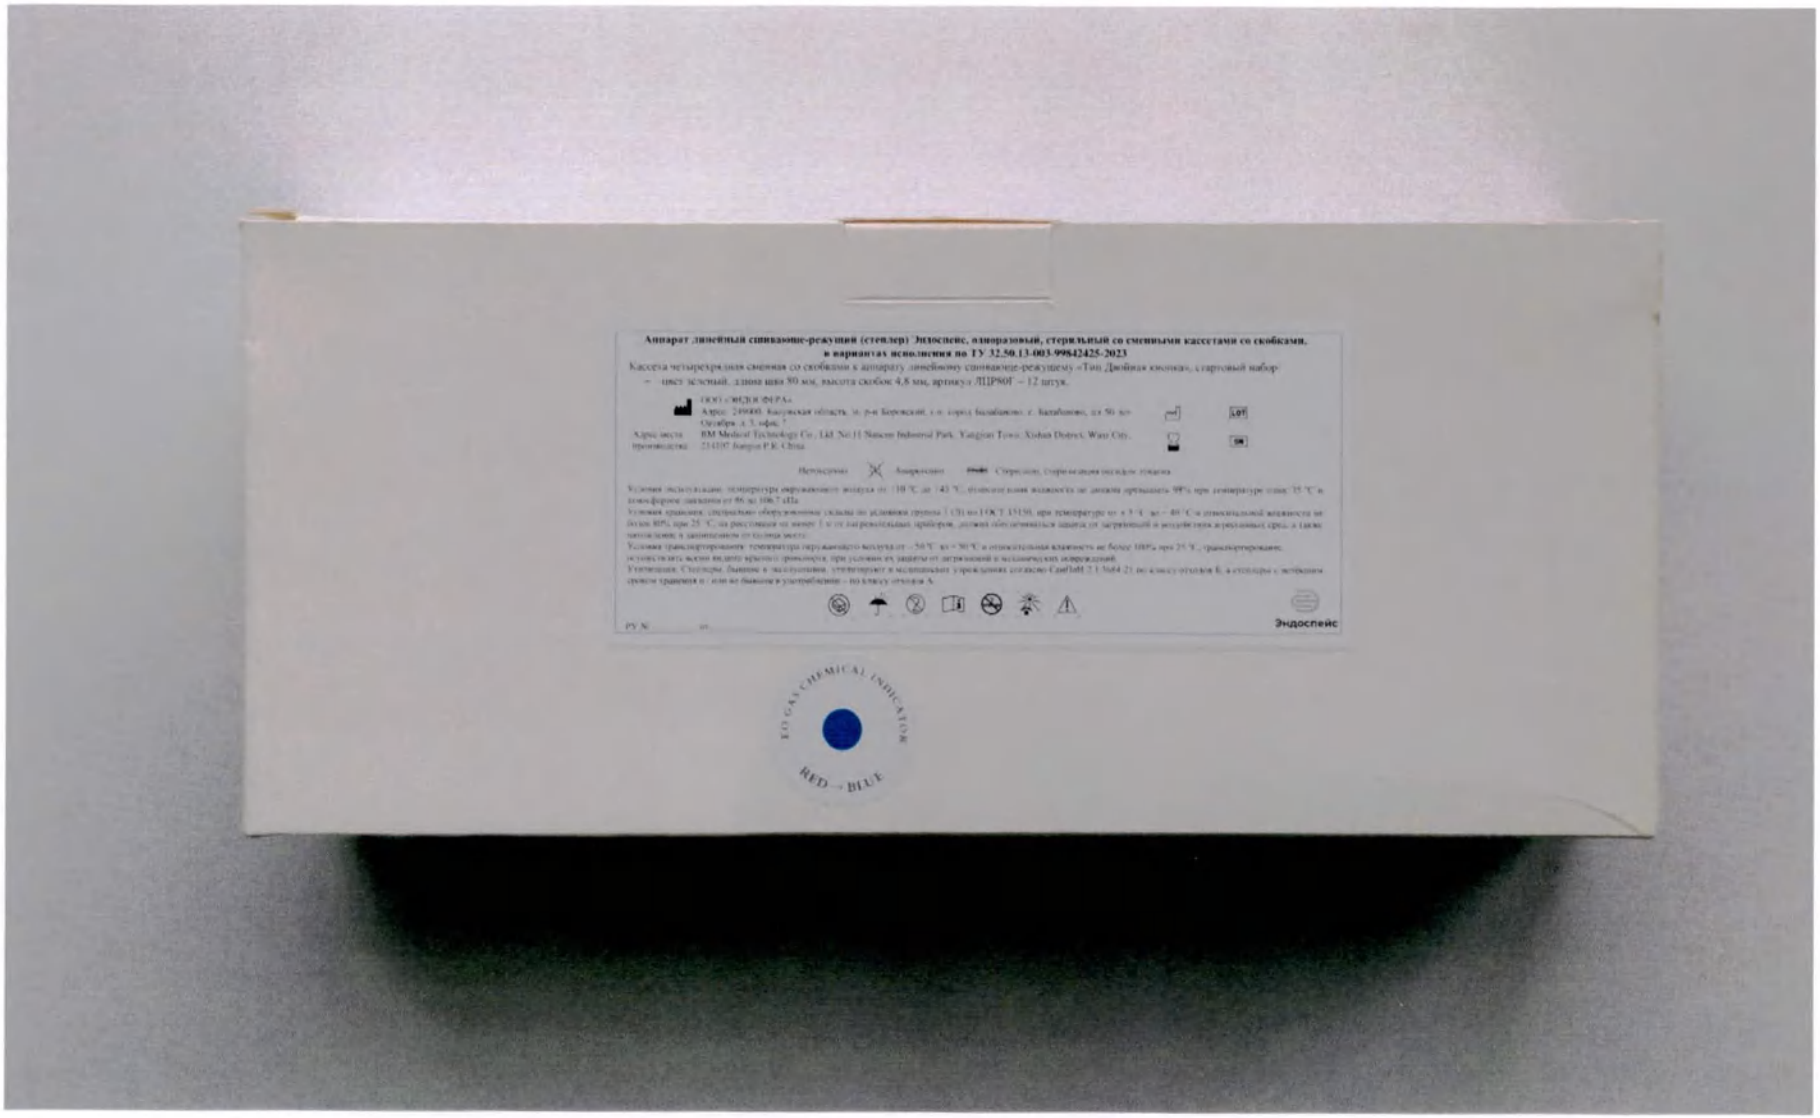

Рисунок 45 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

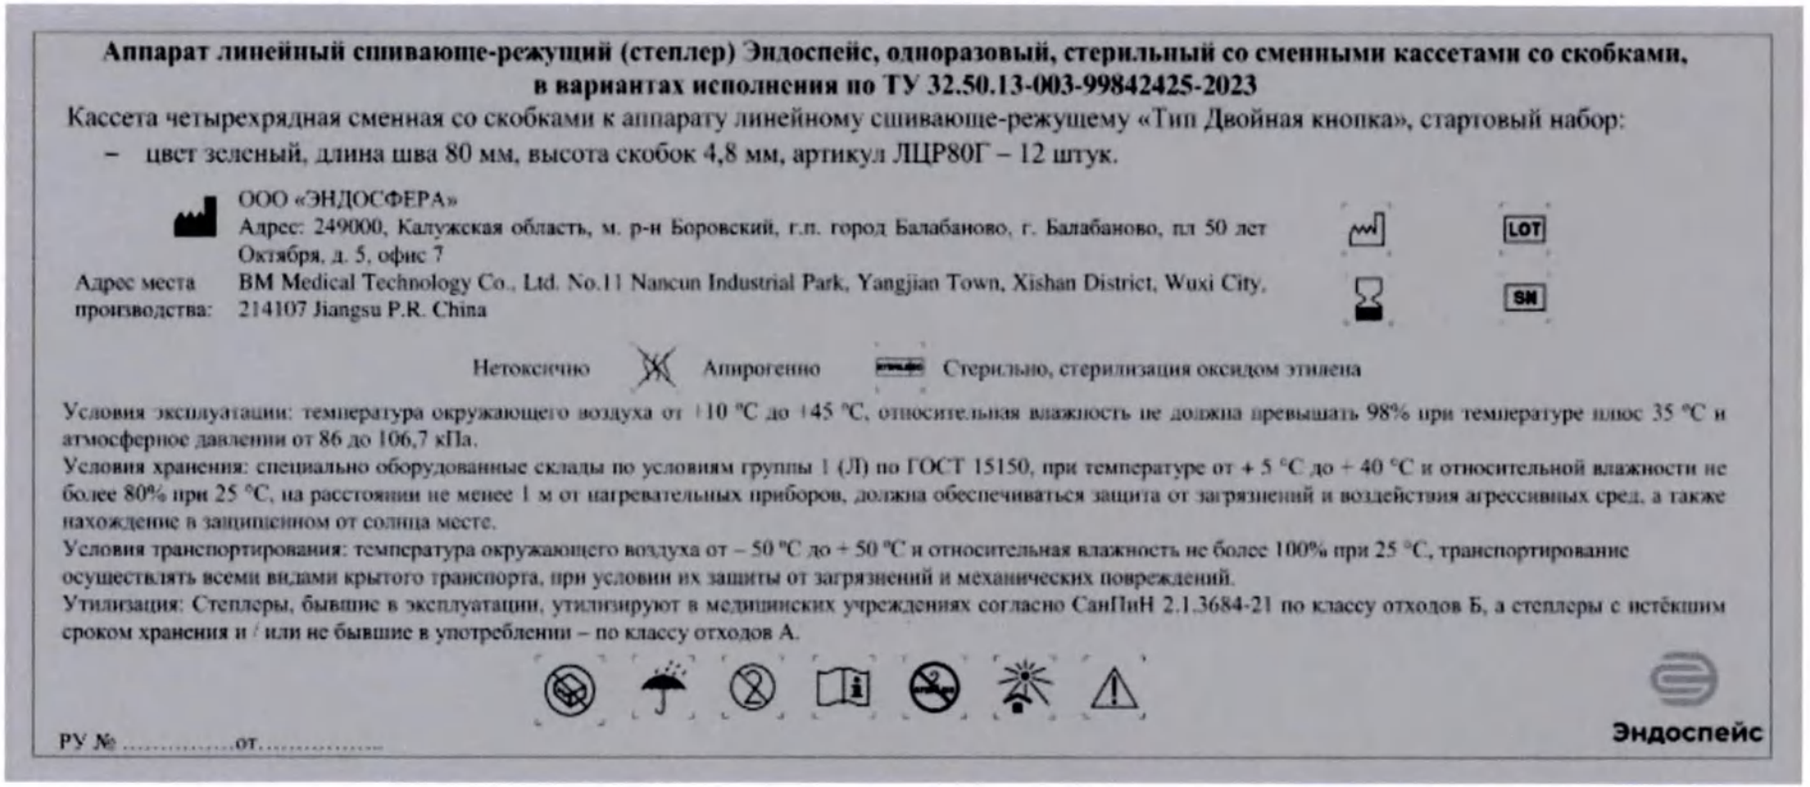

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 45А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 46 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 46А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 47 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

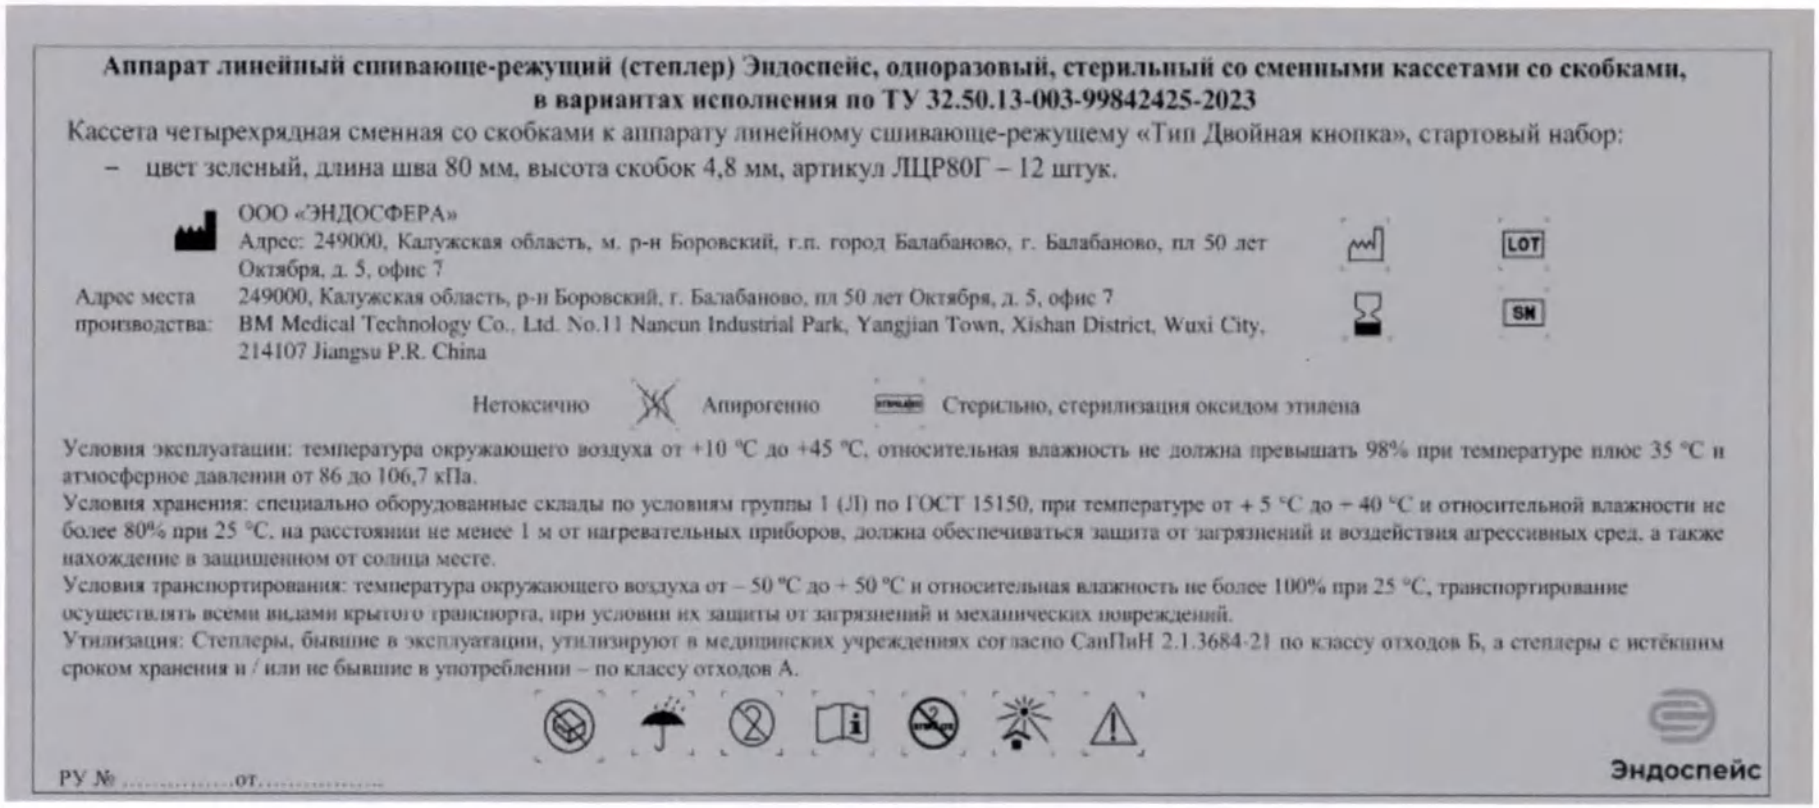

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 47А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

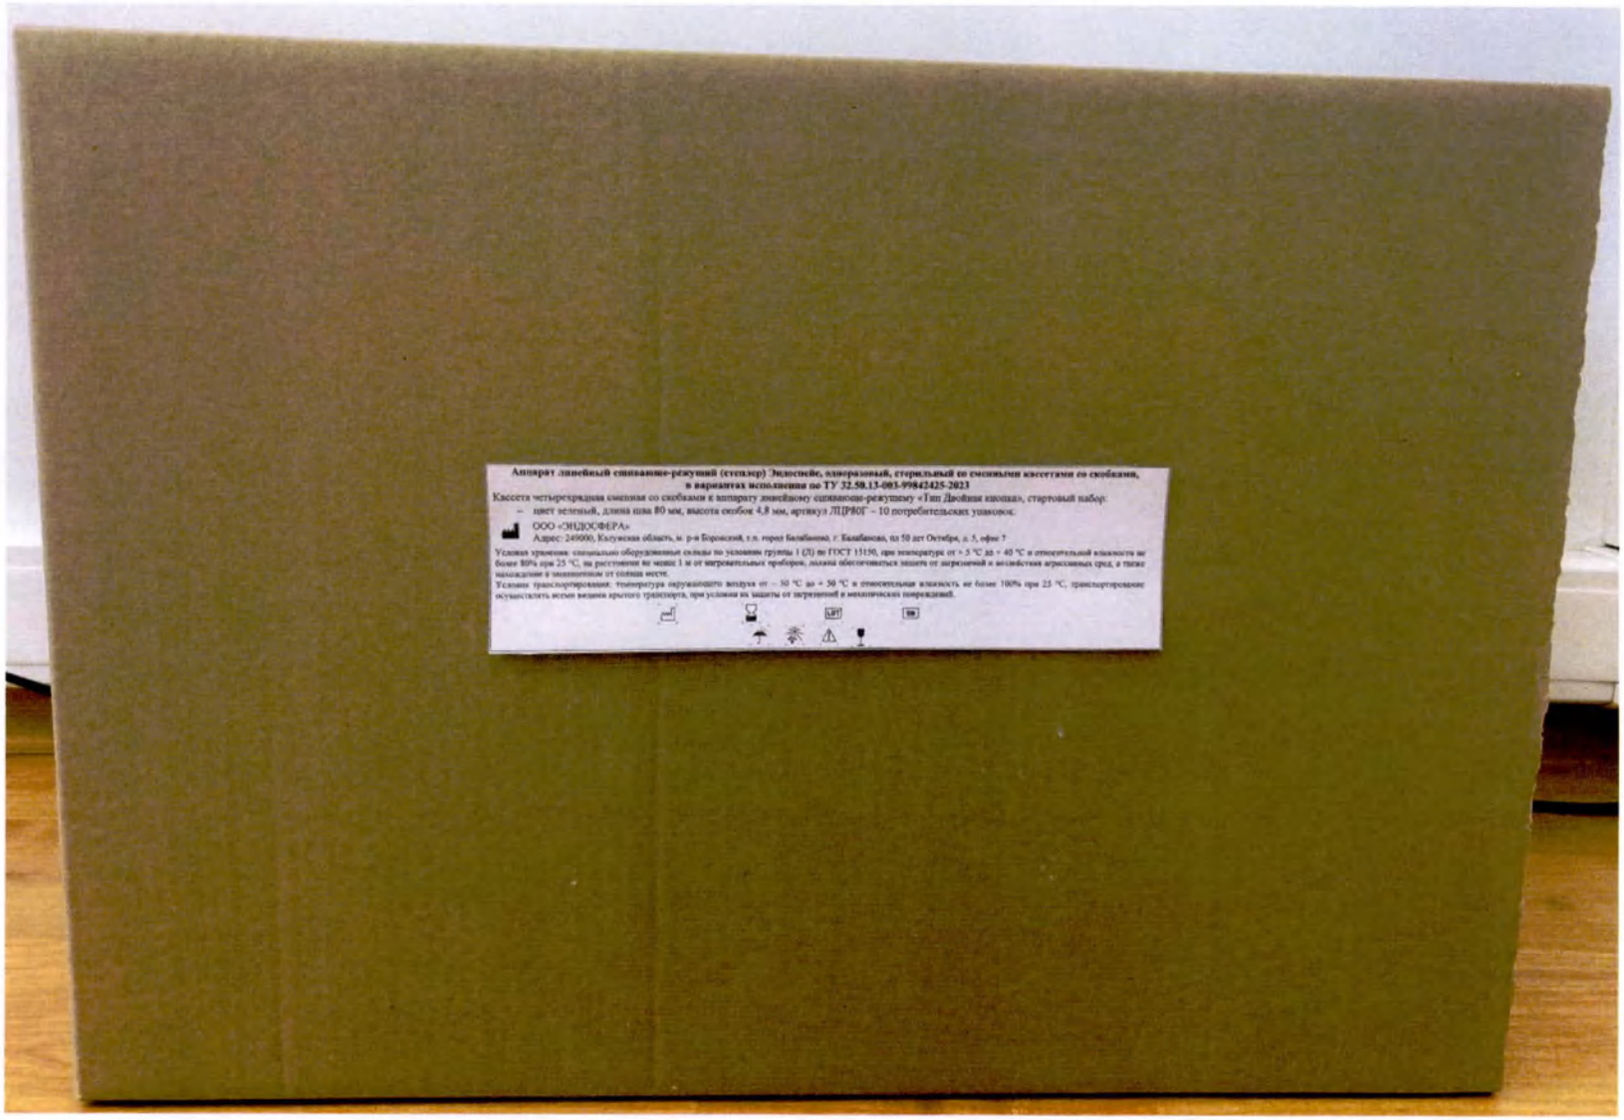

Рисунок 48 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

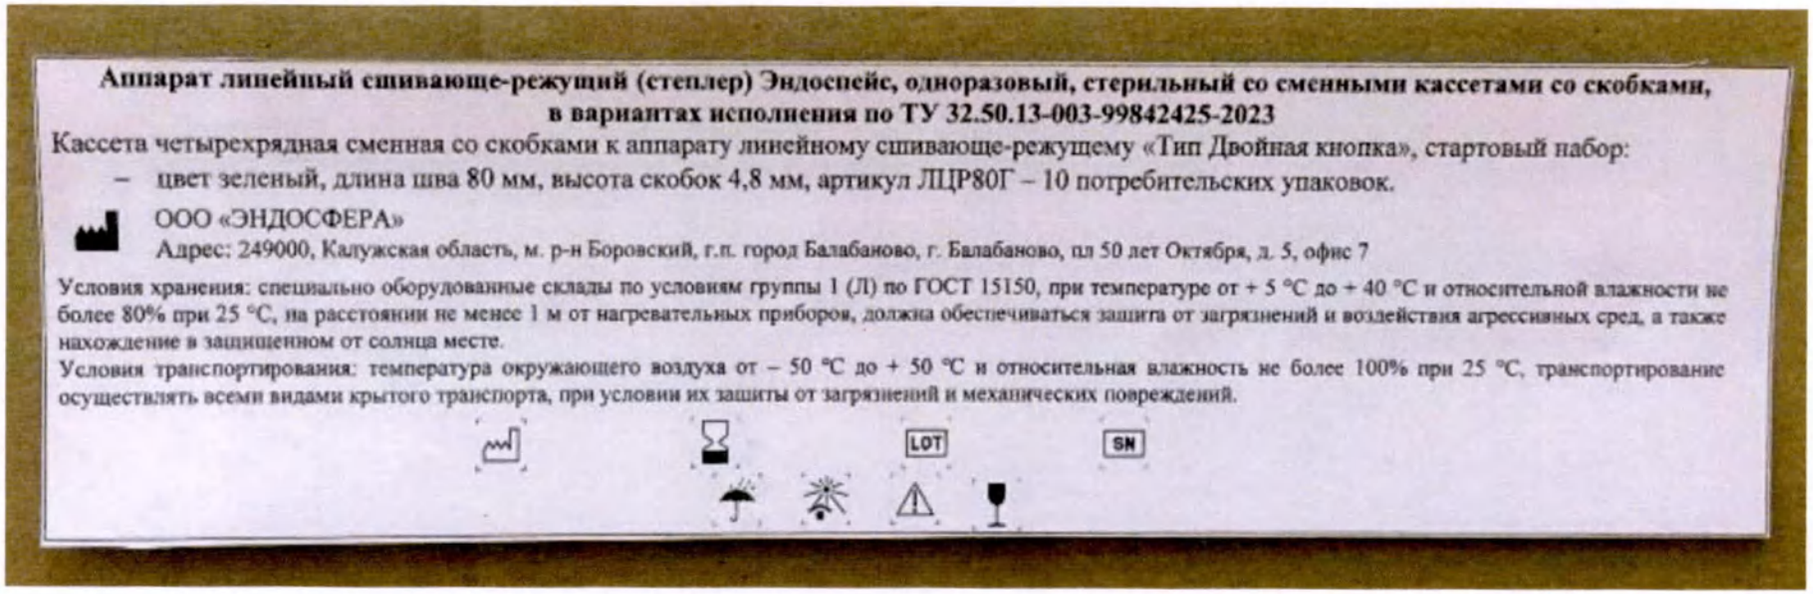

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 48А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 80 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

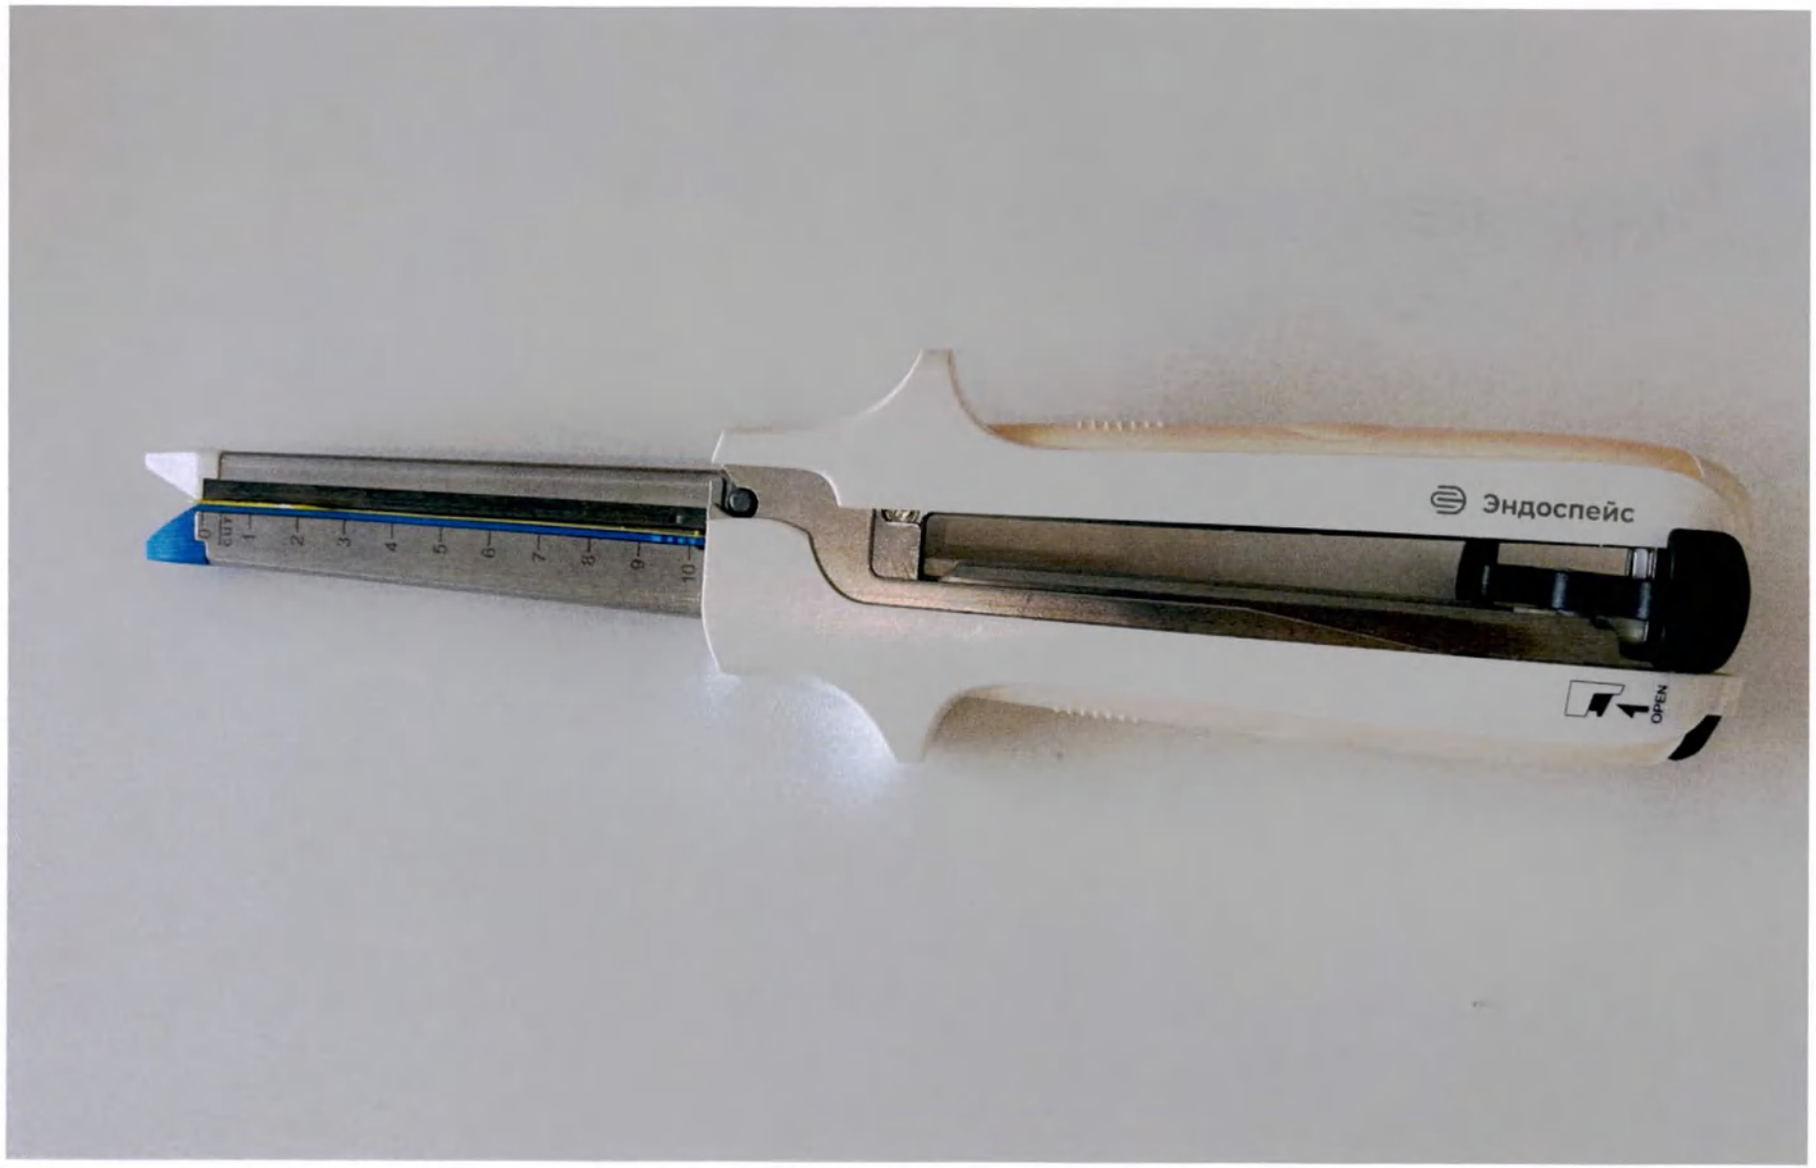

Рисунок 49 – Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 50 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

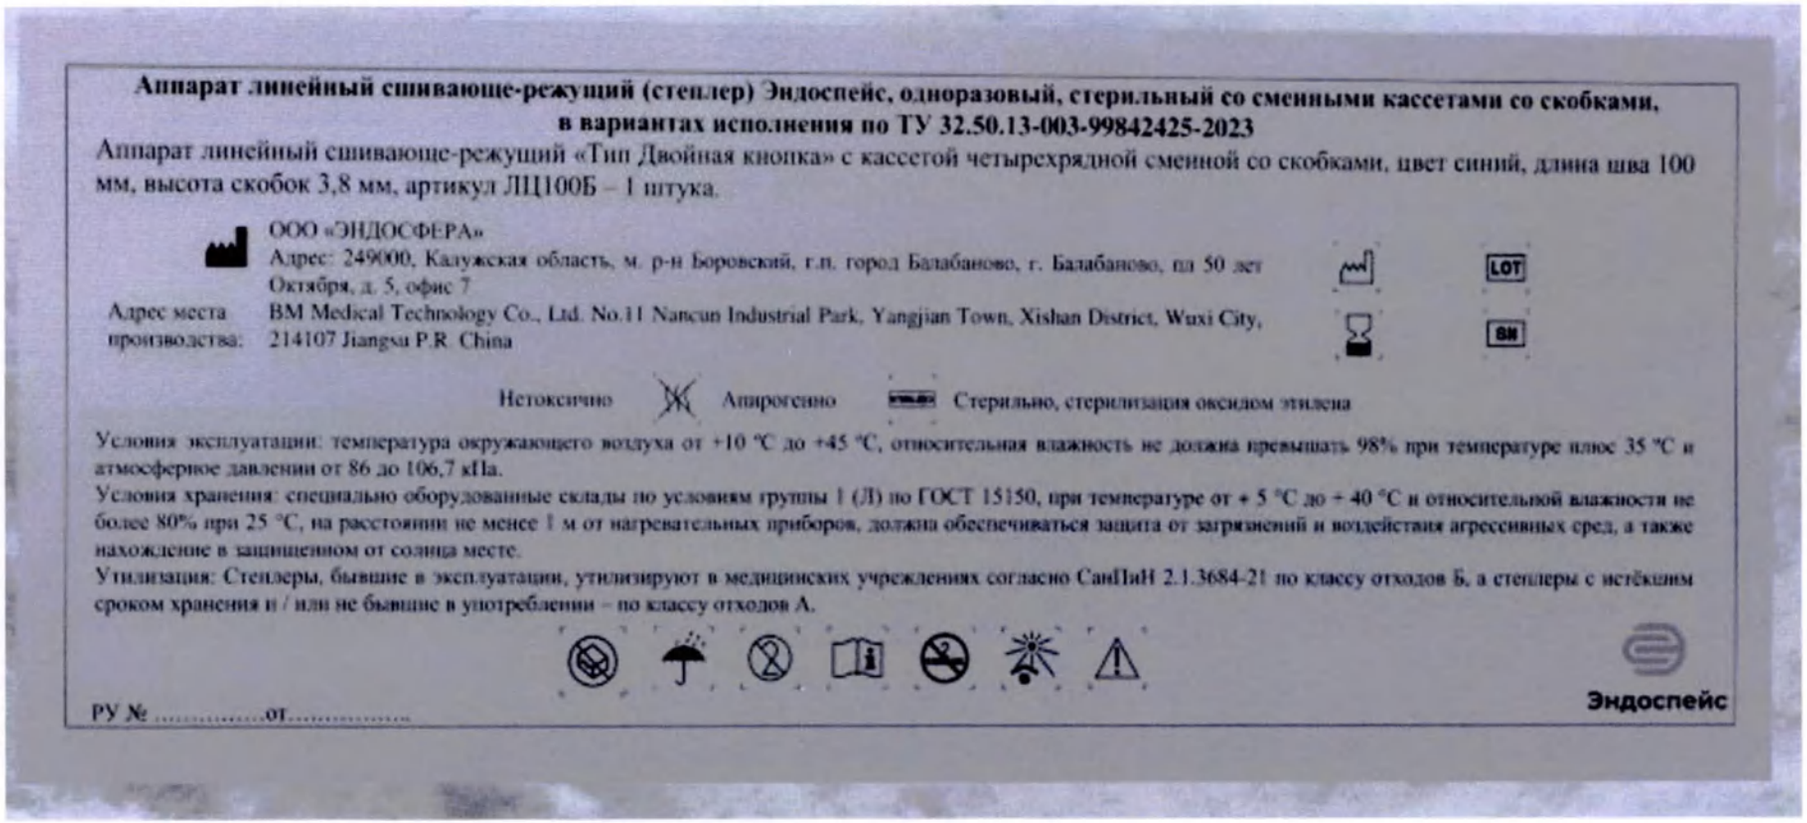

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 50А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 51 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 51А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

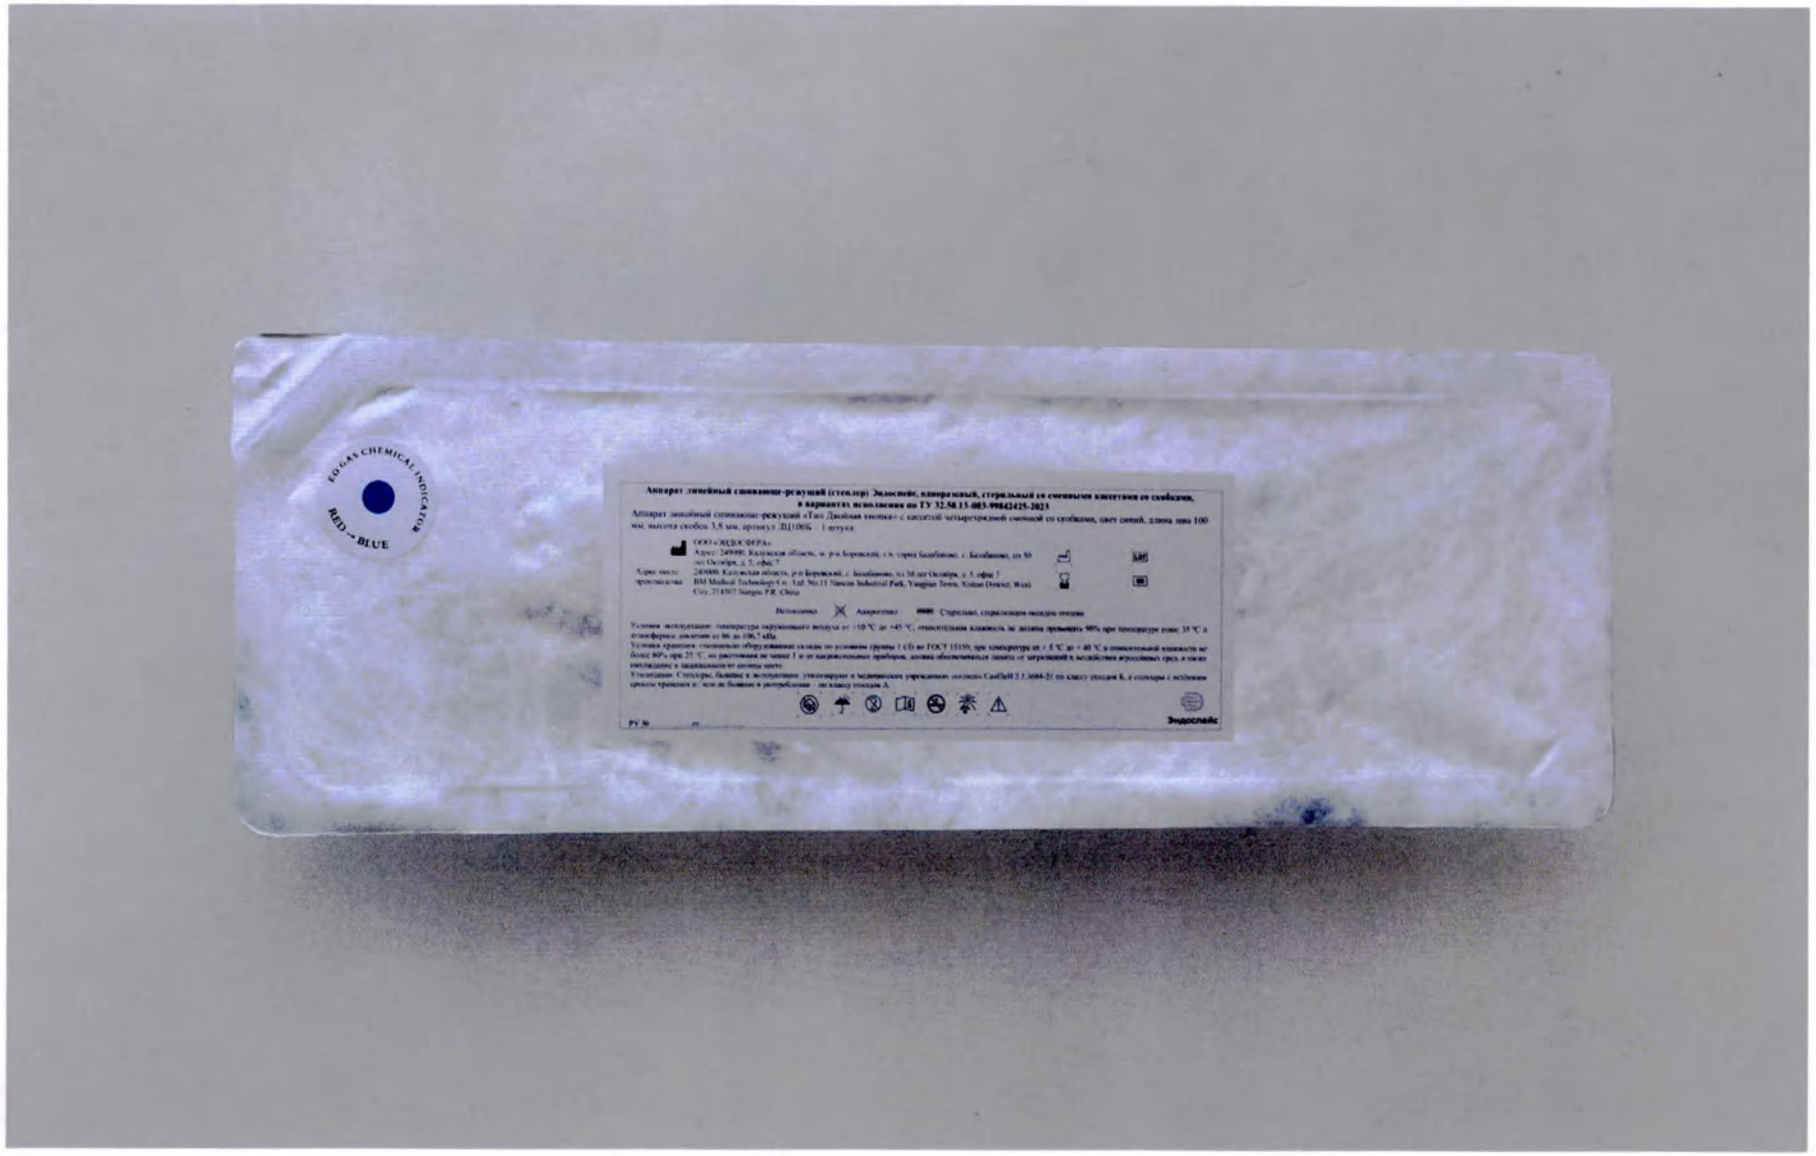

Рисунок 52 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

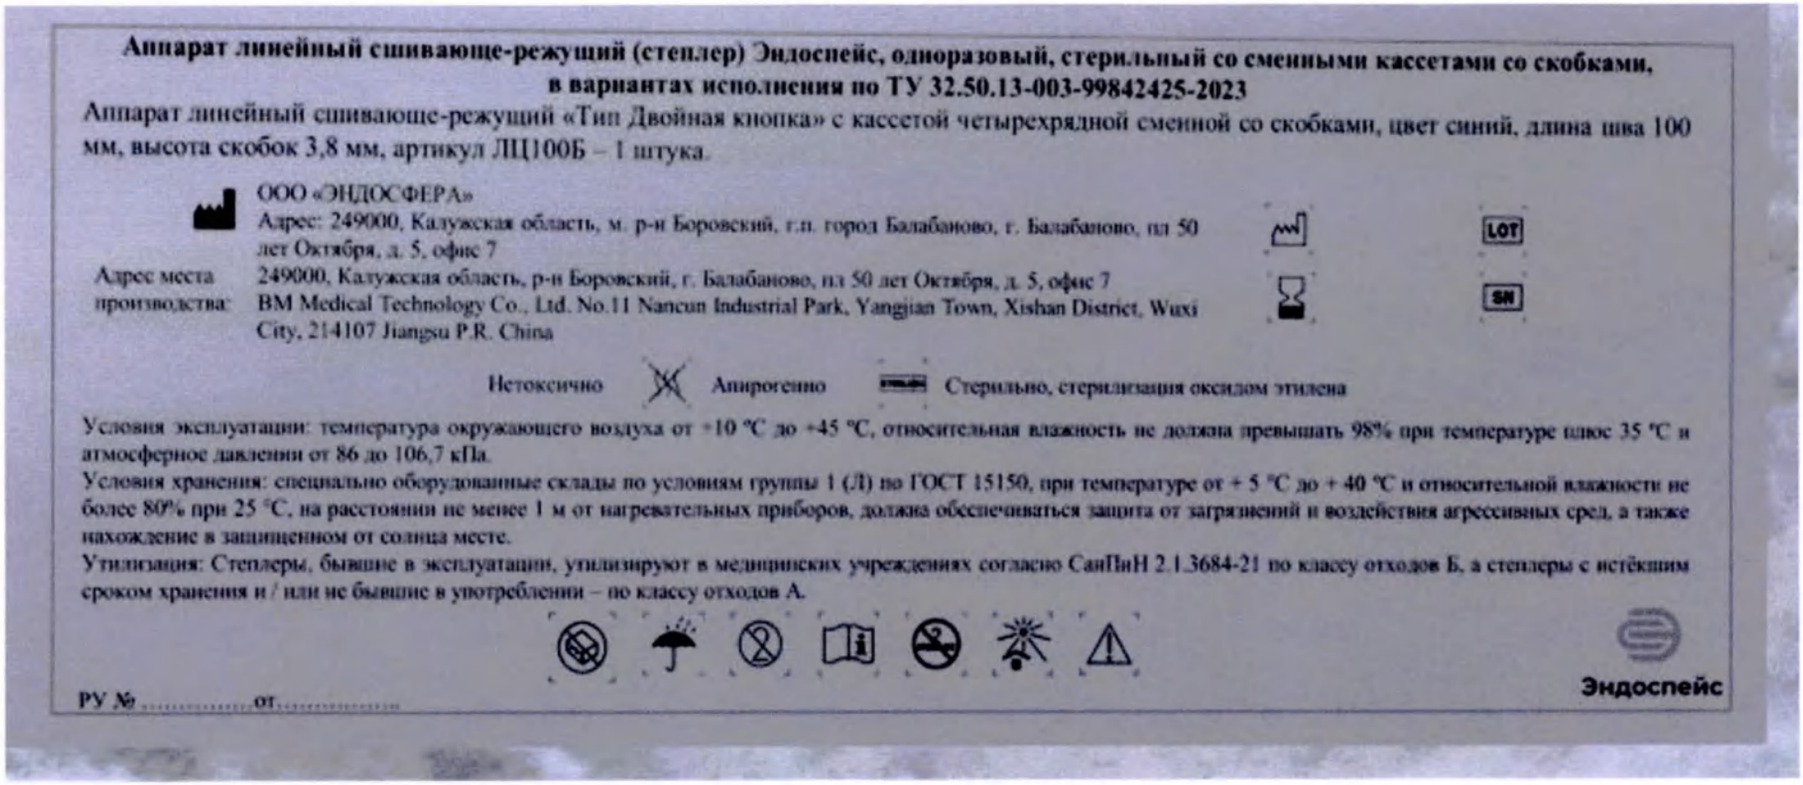

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ..... от .....

Эндоспейс

Рисунок 52А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 53 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 53А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 54 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

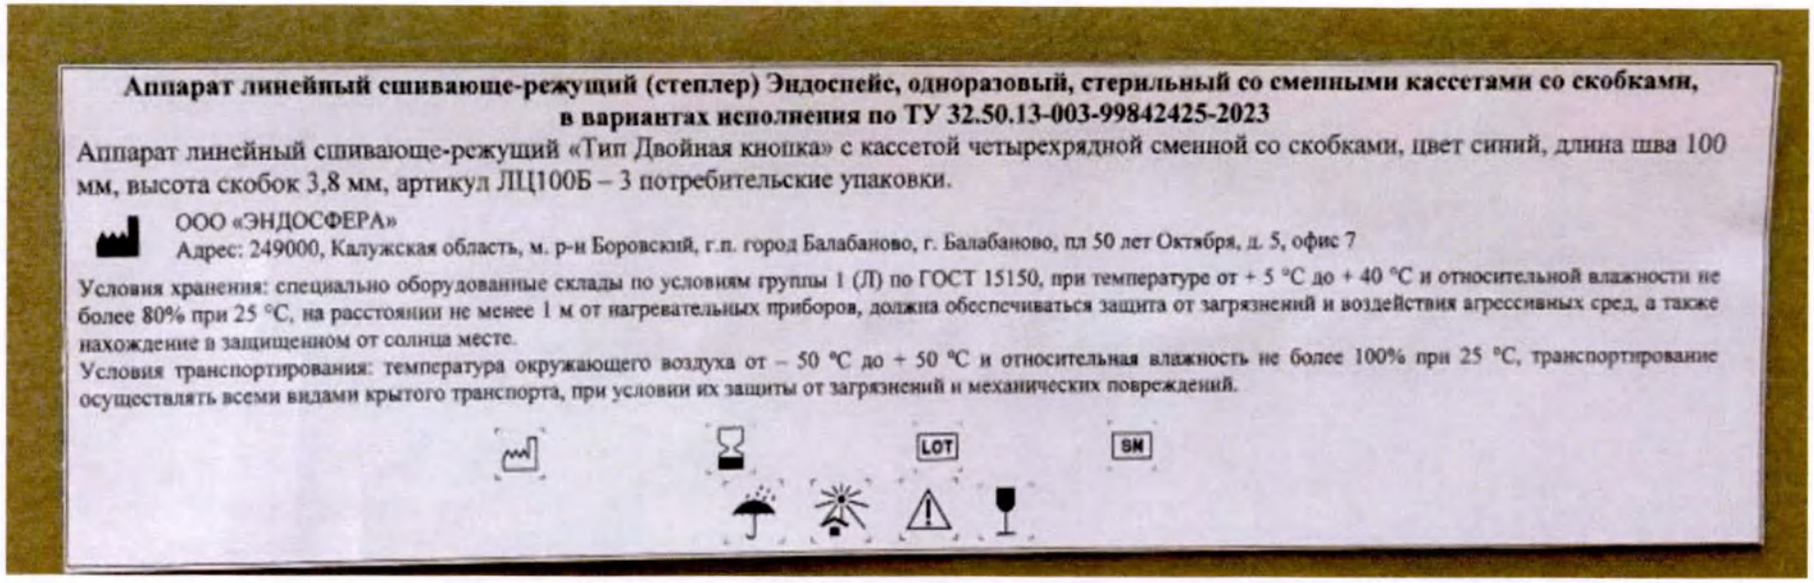

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 54А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

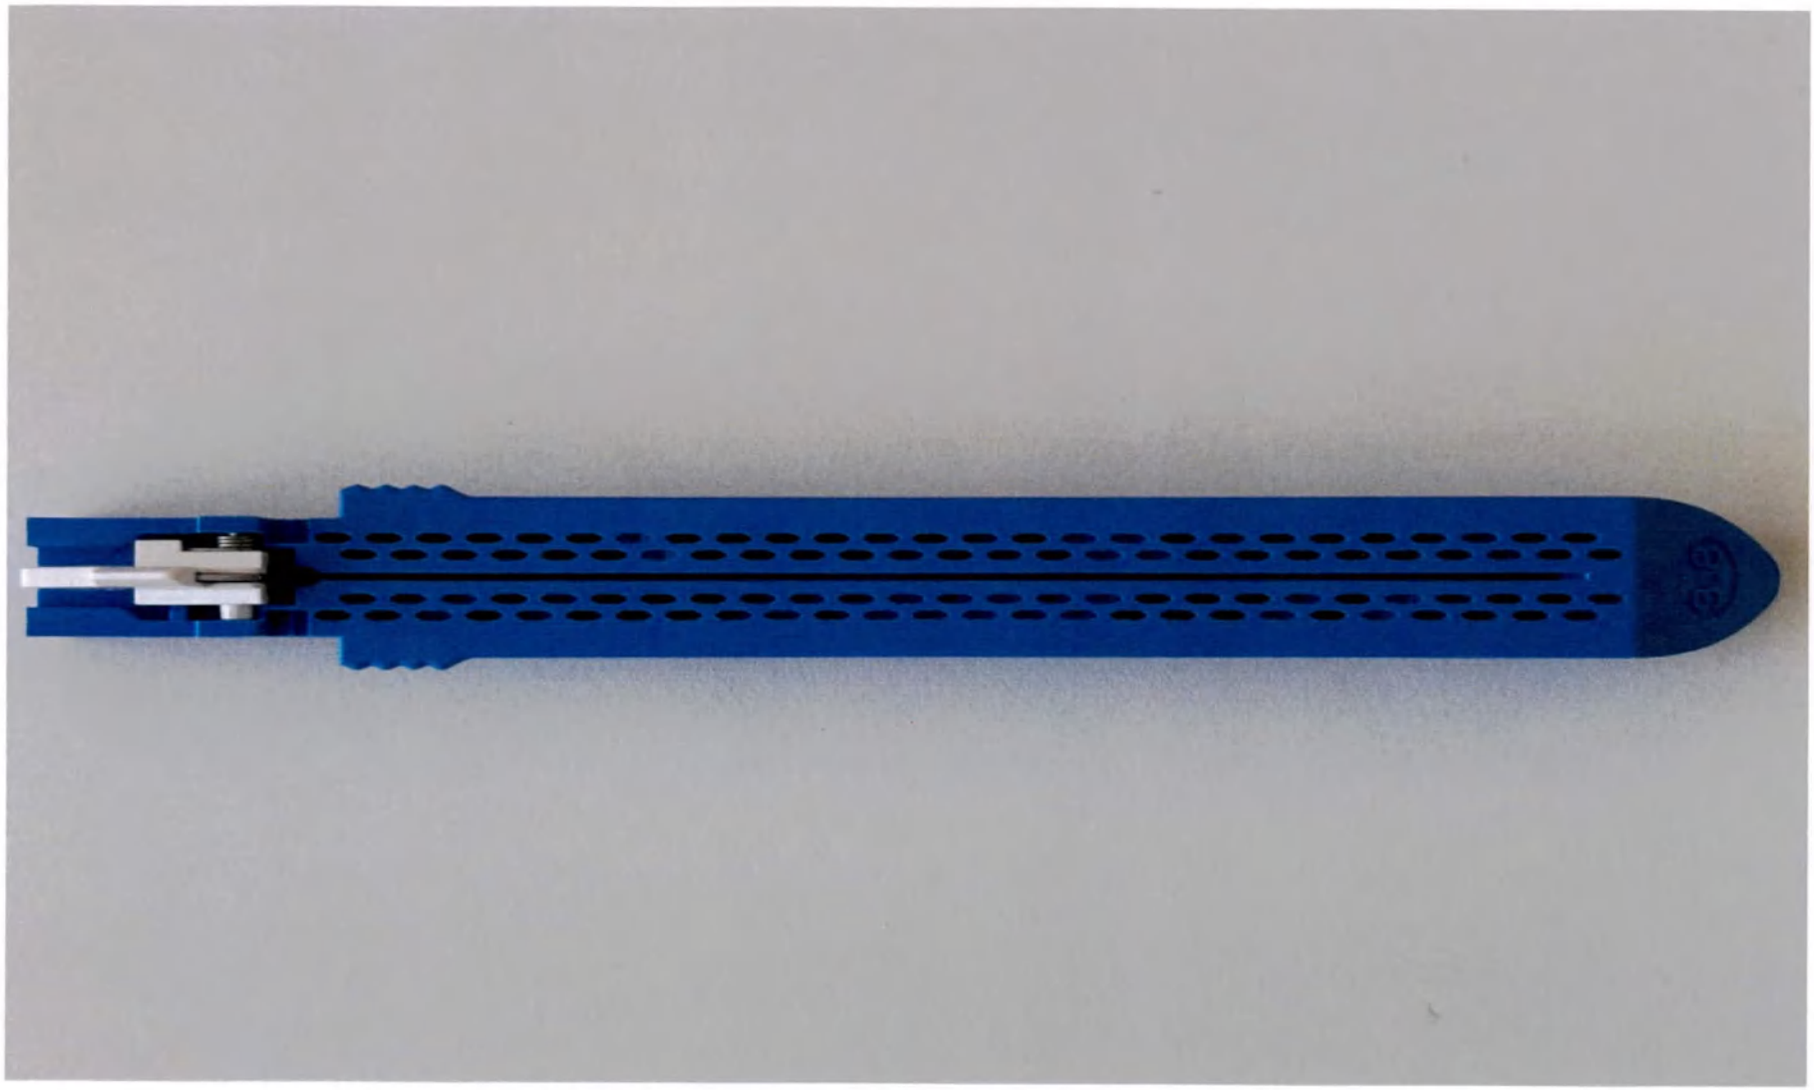

Рисунок 55 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 56 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 56А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

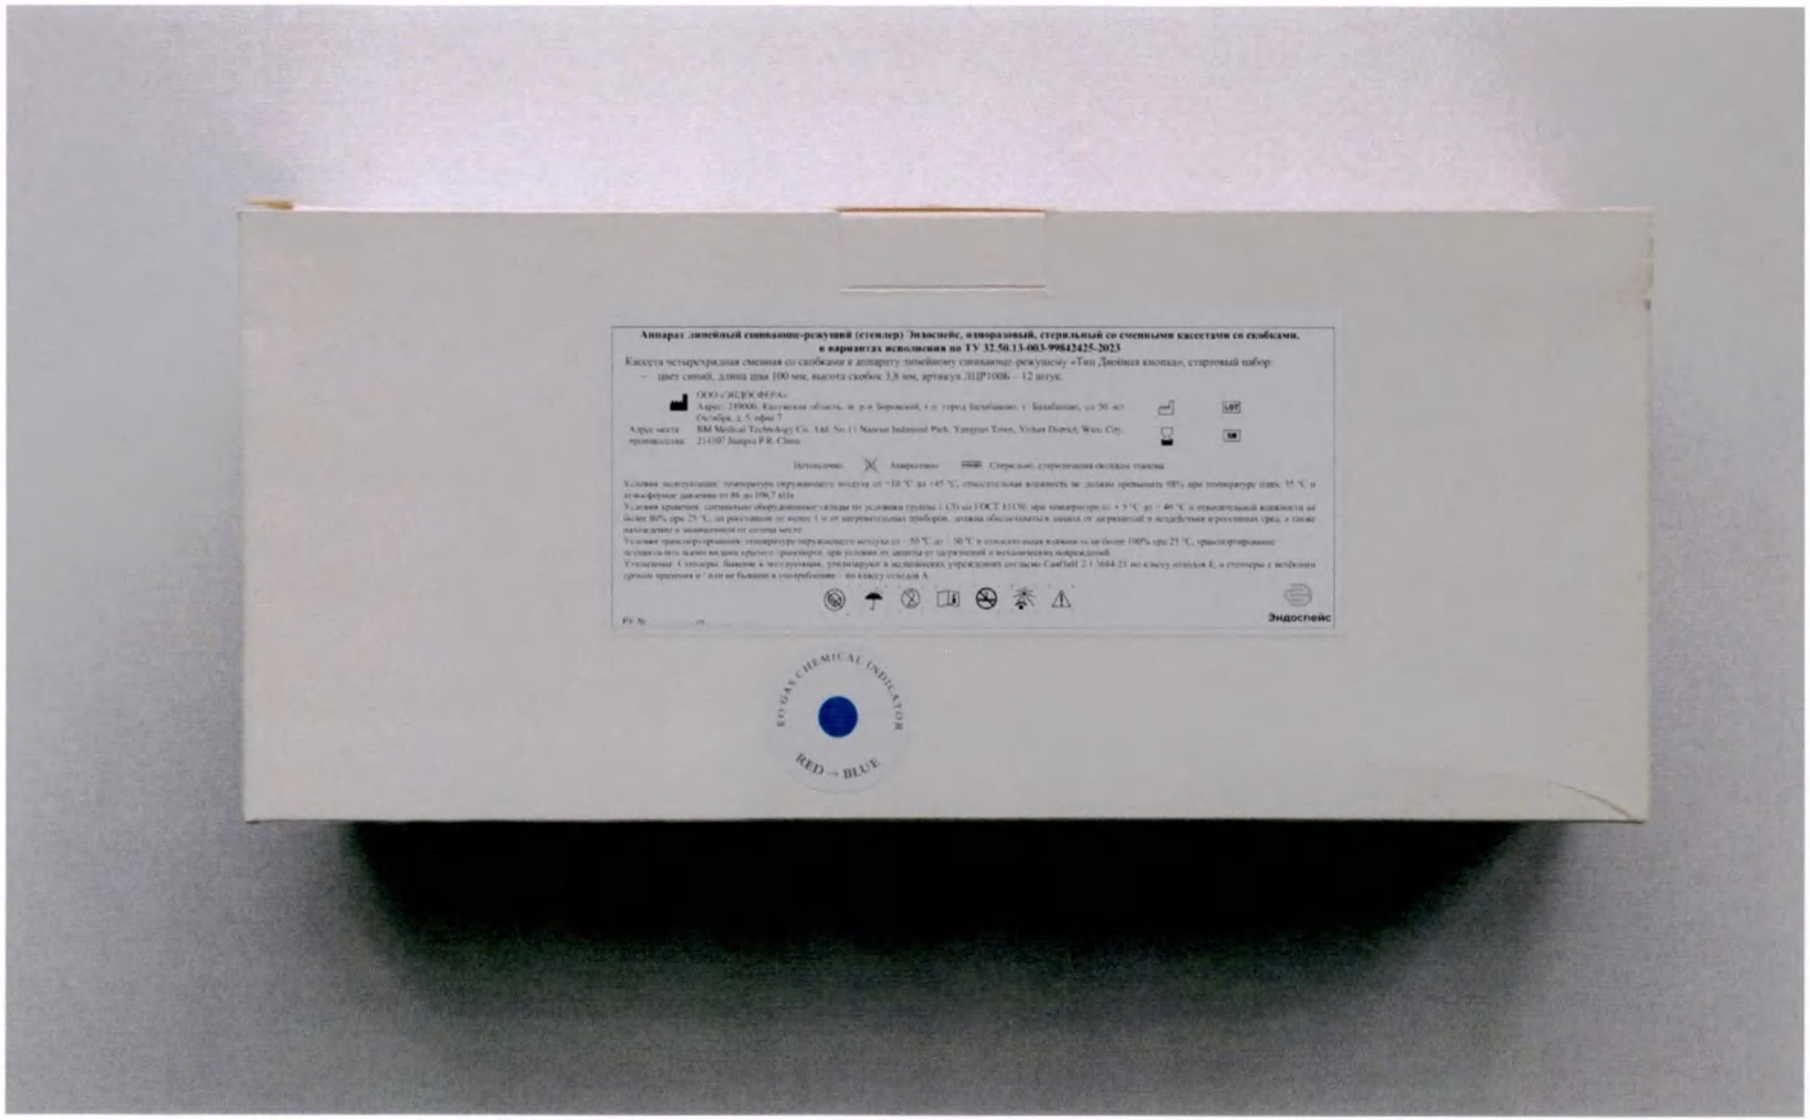

Рисунок 57 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

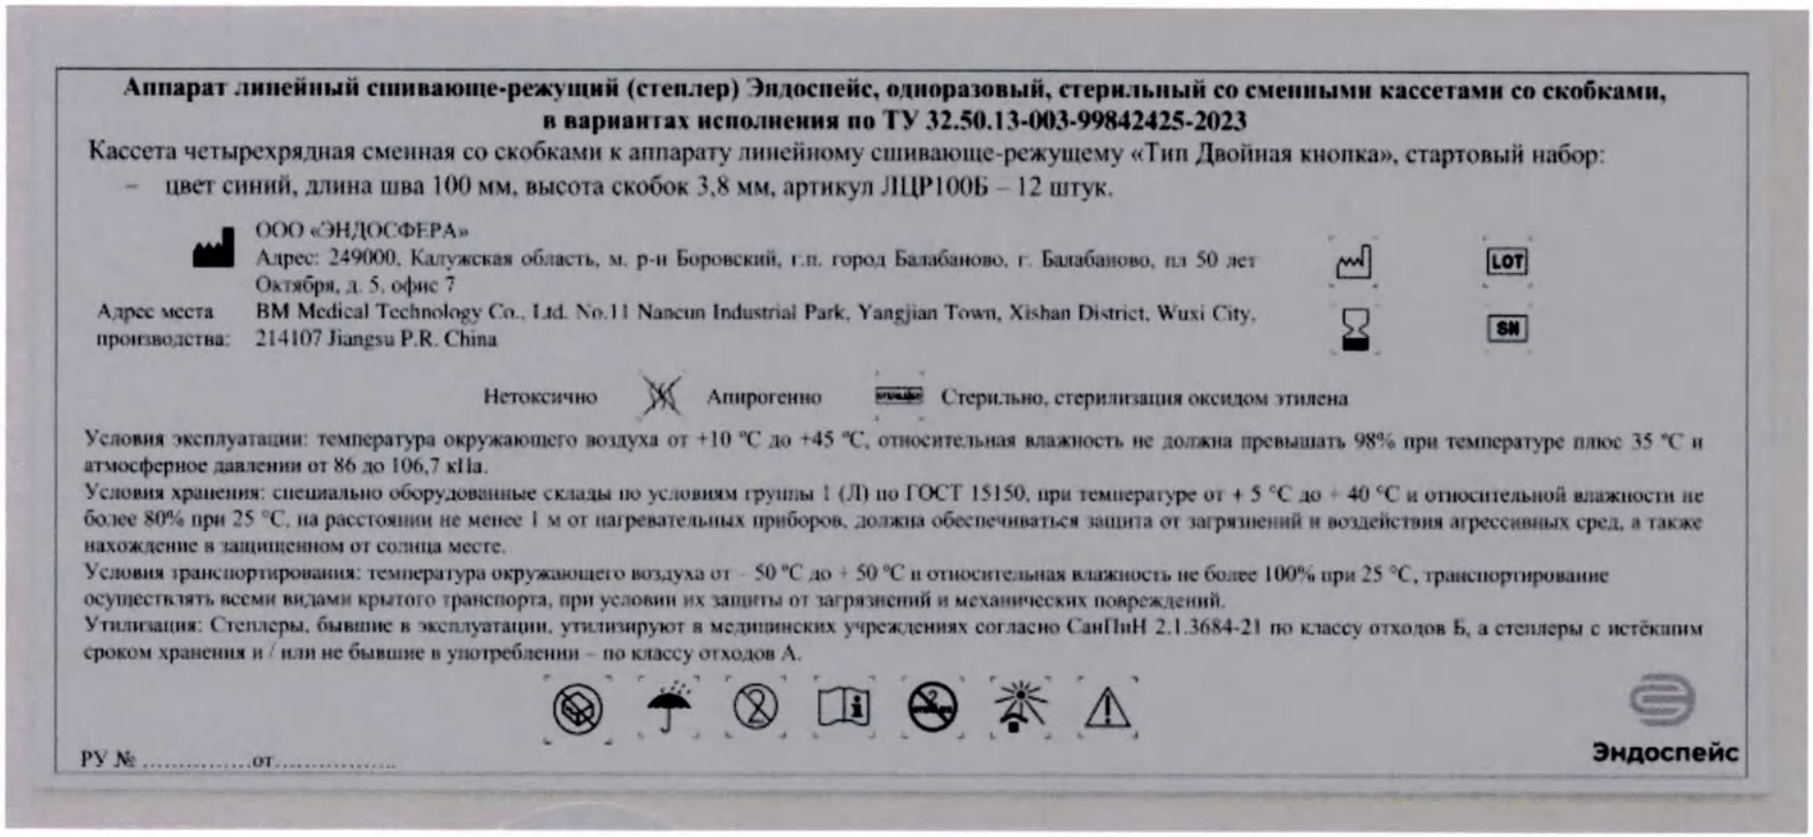

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

Рисунок 57А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 58 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 58А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 59 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

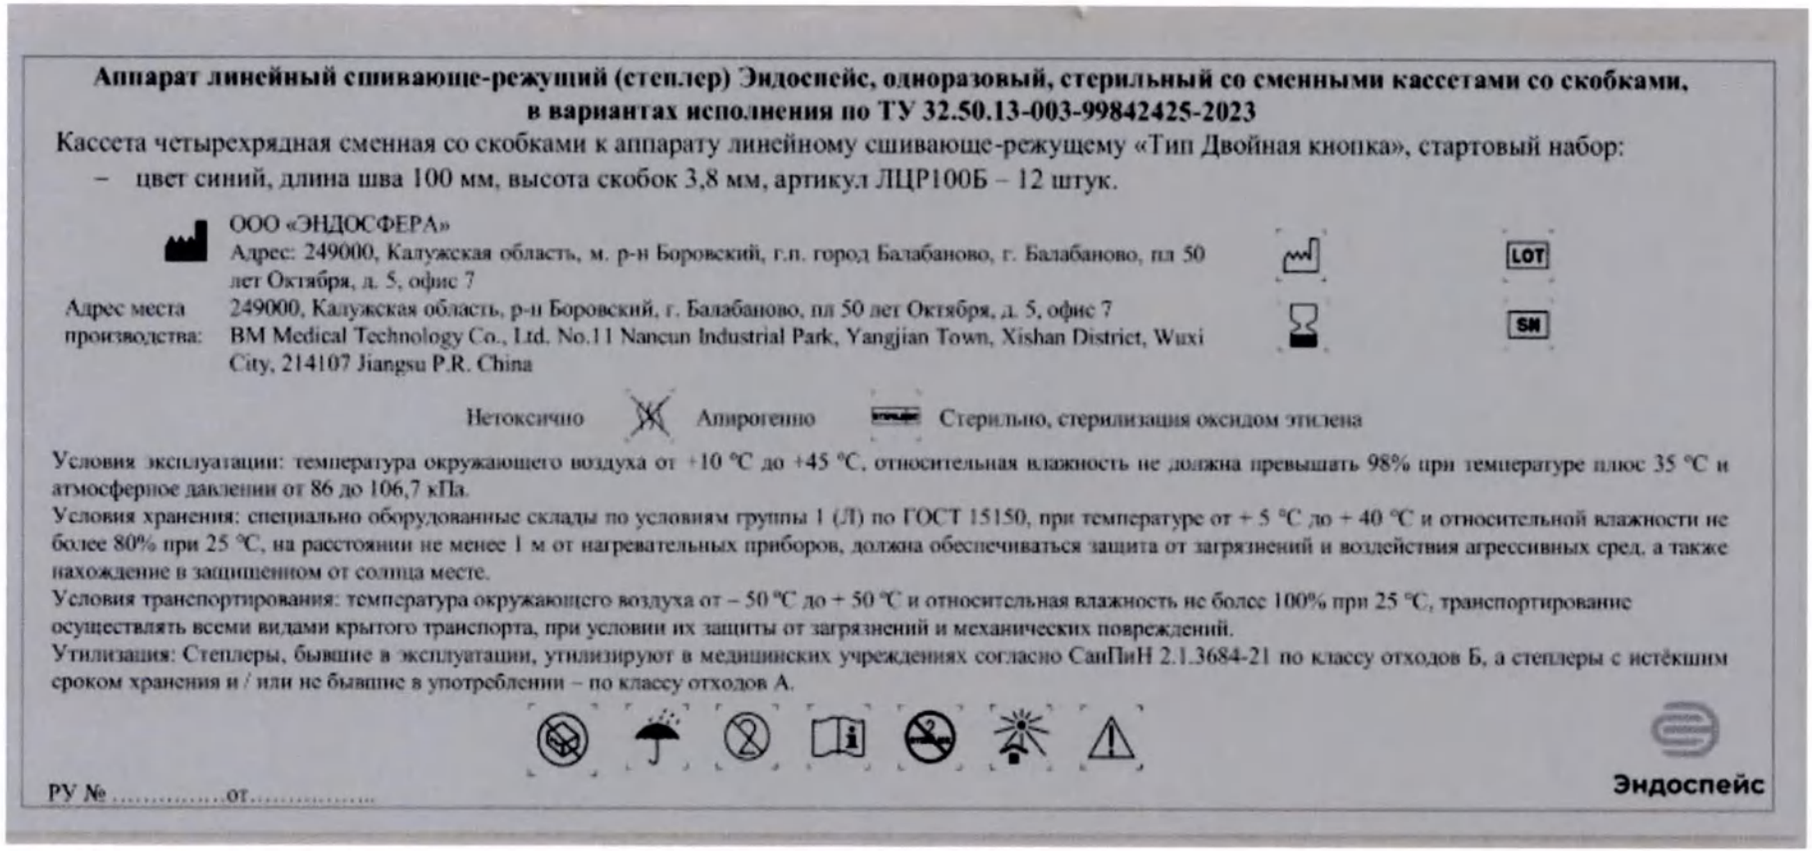

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 59А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 60 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

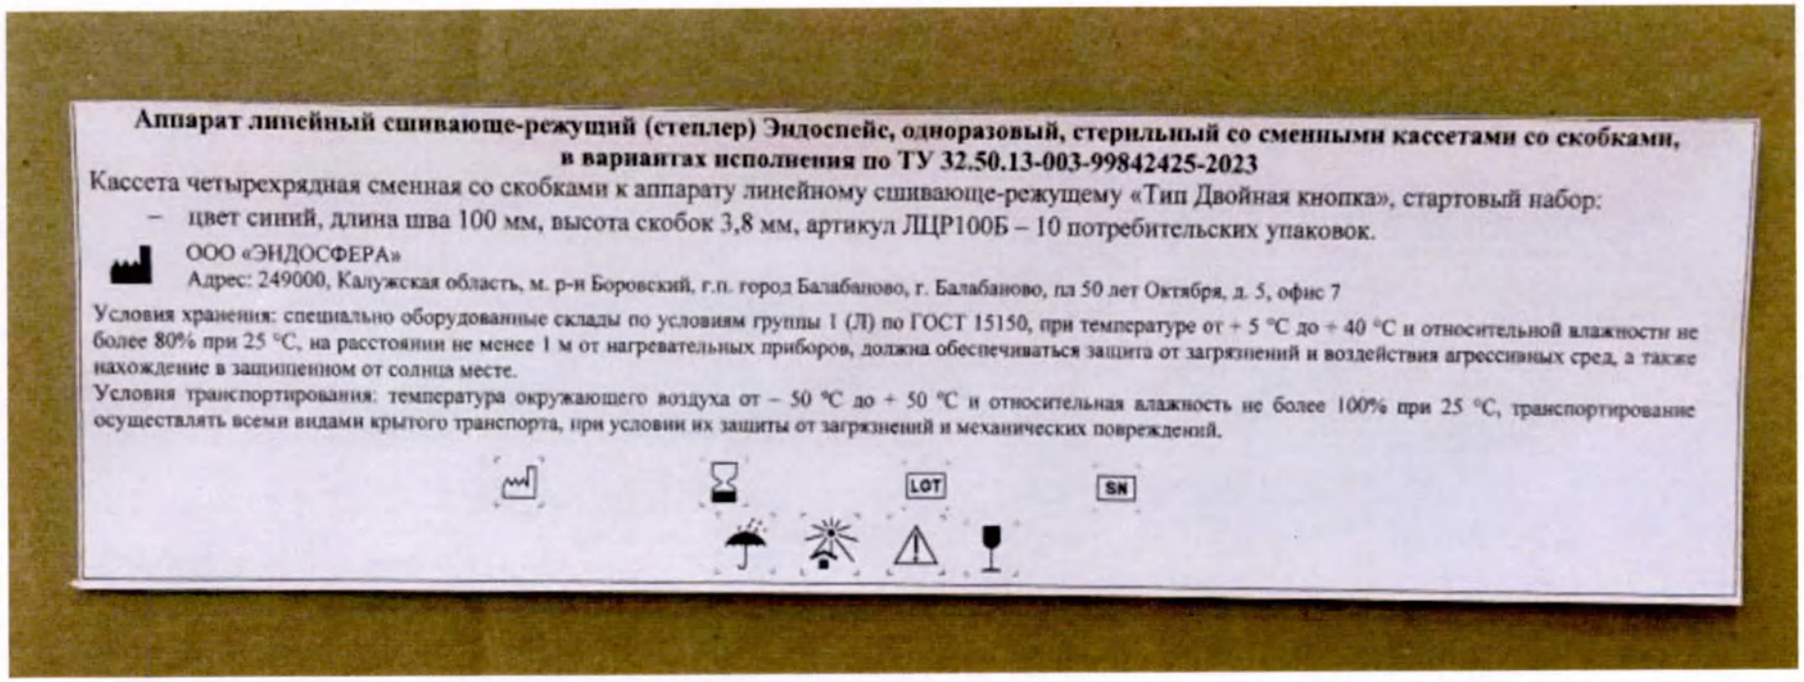

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

LOT SN

Рисунок 60А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

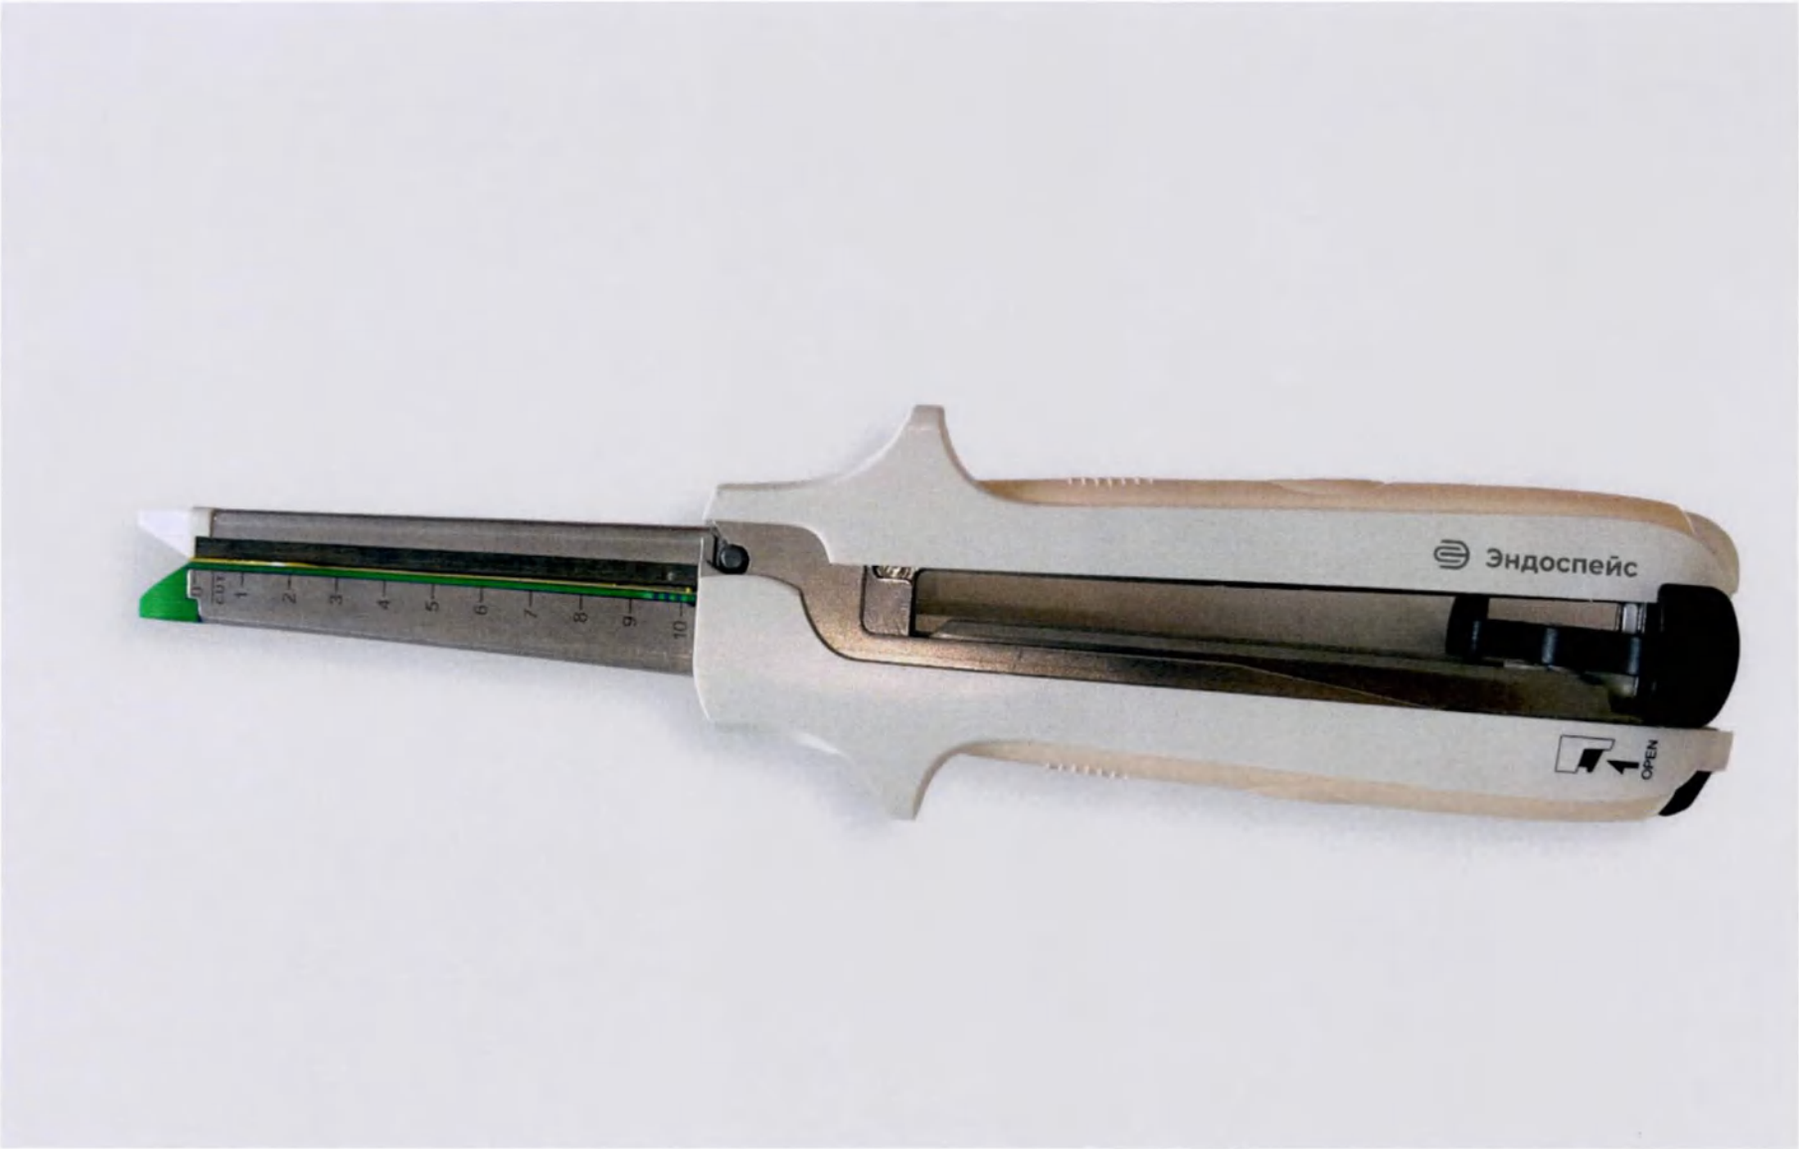

Рисунок 61 – Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 62 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейног сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

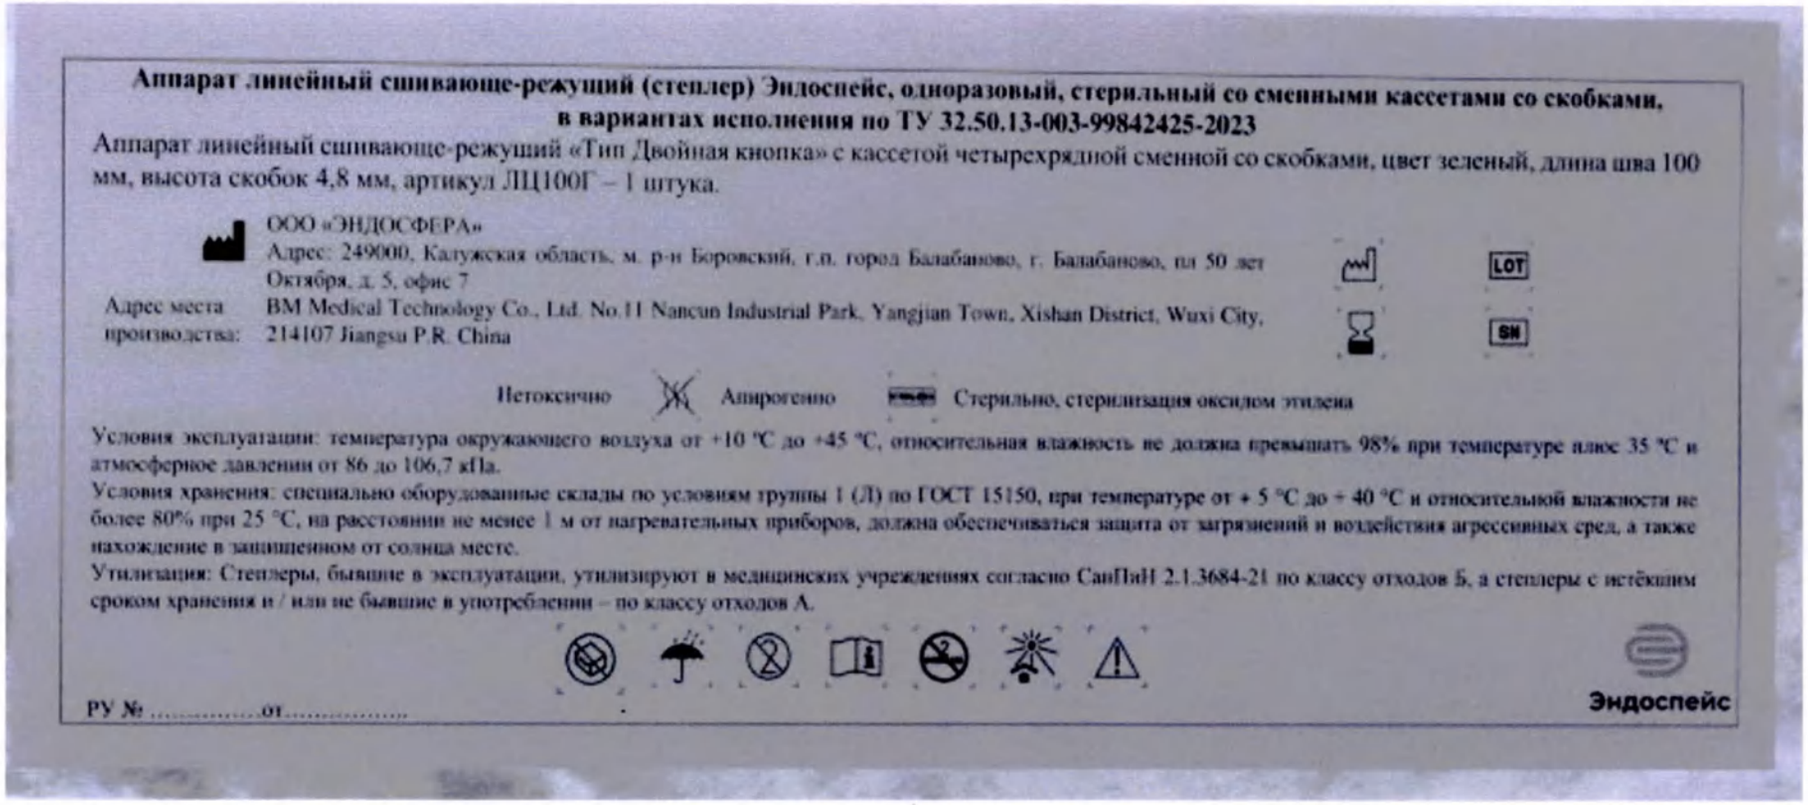

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 62А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейног сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 63 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейног сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 100 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛЦ100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 63А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейног сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

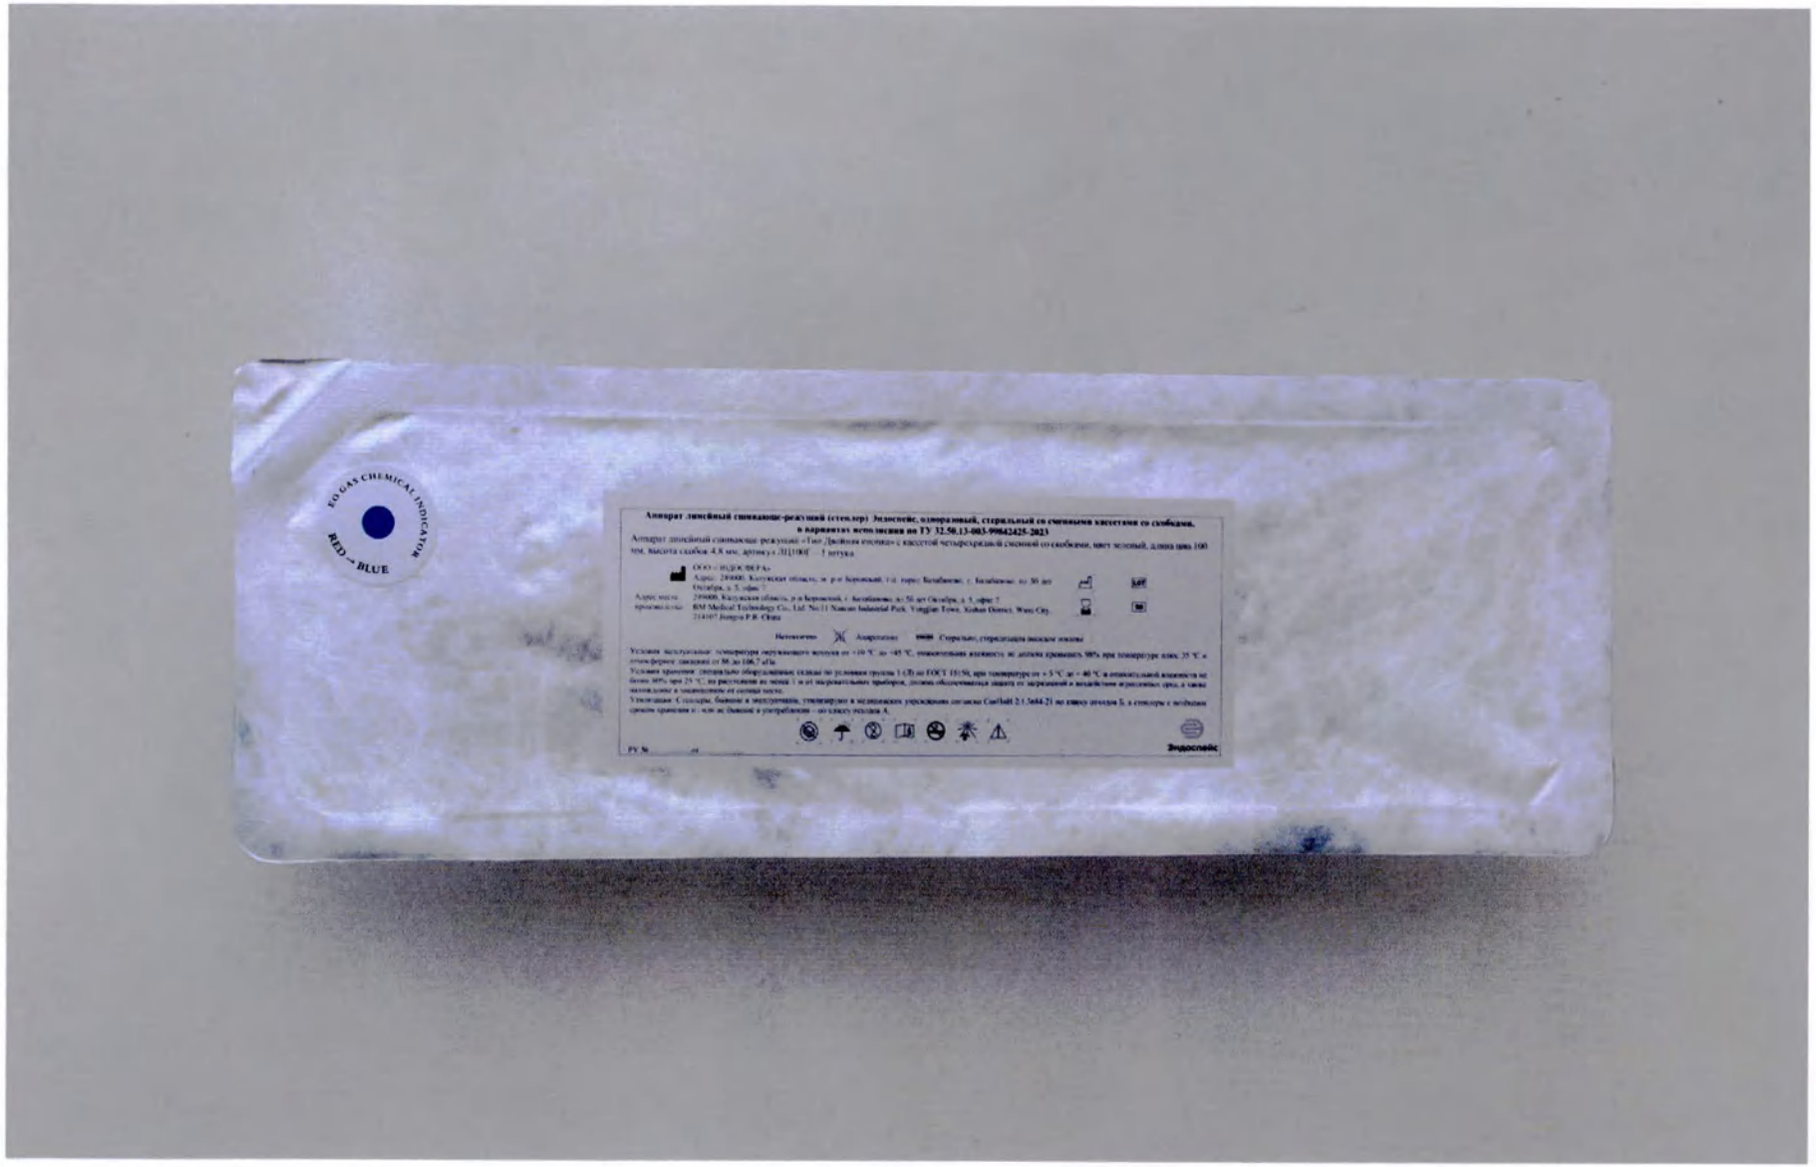

Рисунок 64 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейног сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

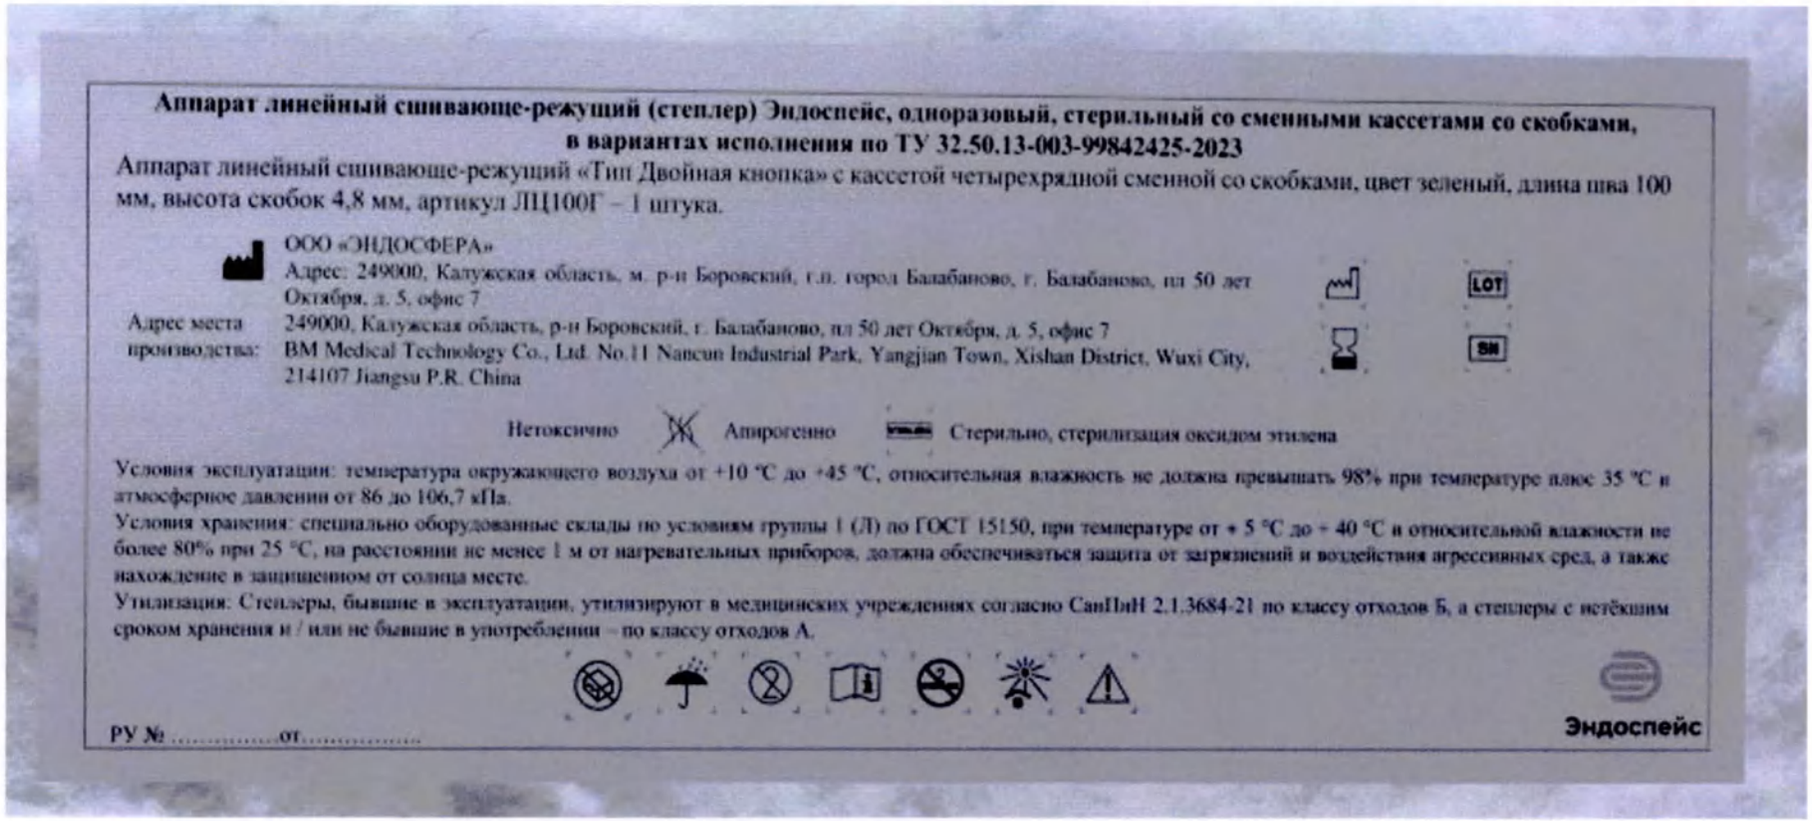

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 64А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейног сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 65 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейног сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 65А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейног сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

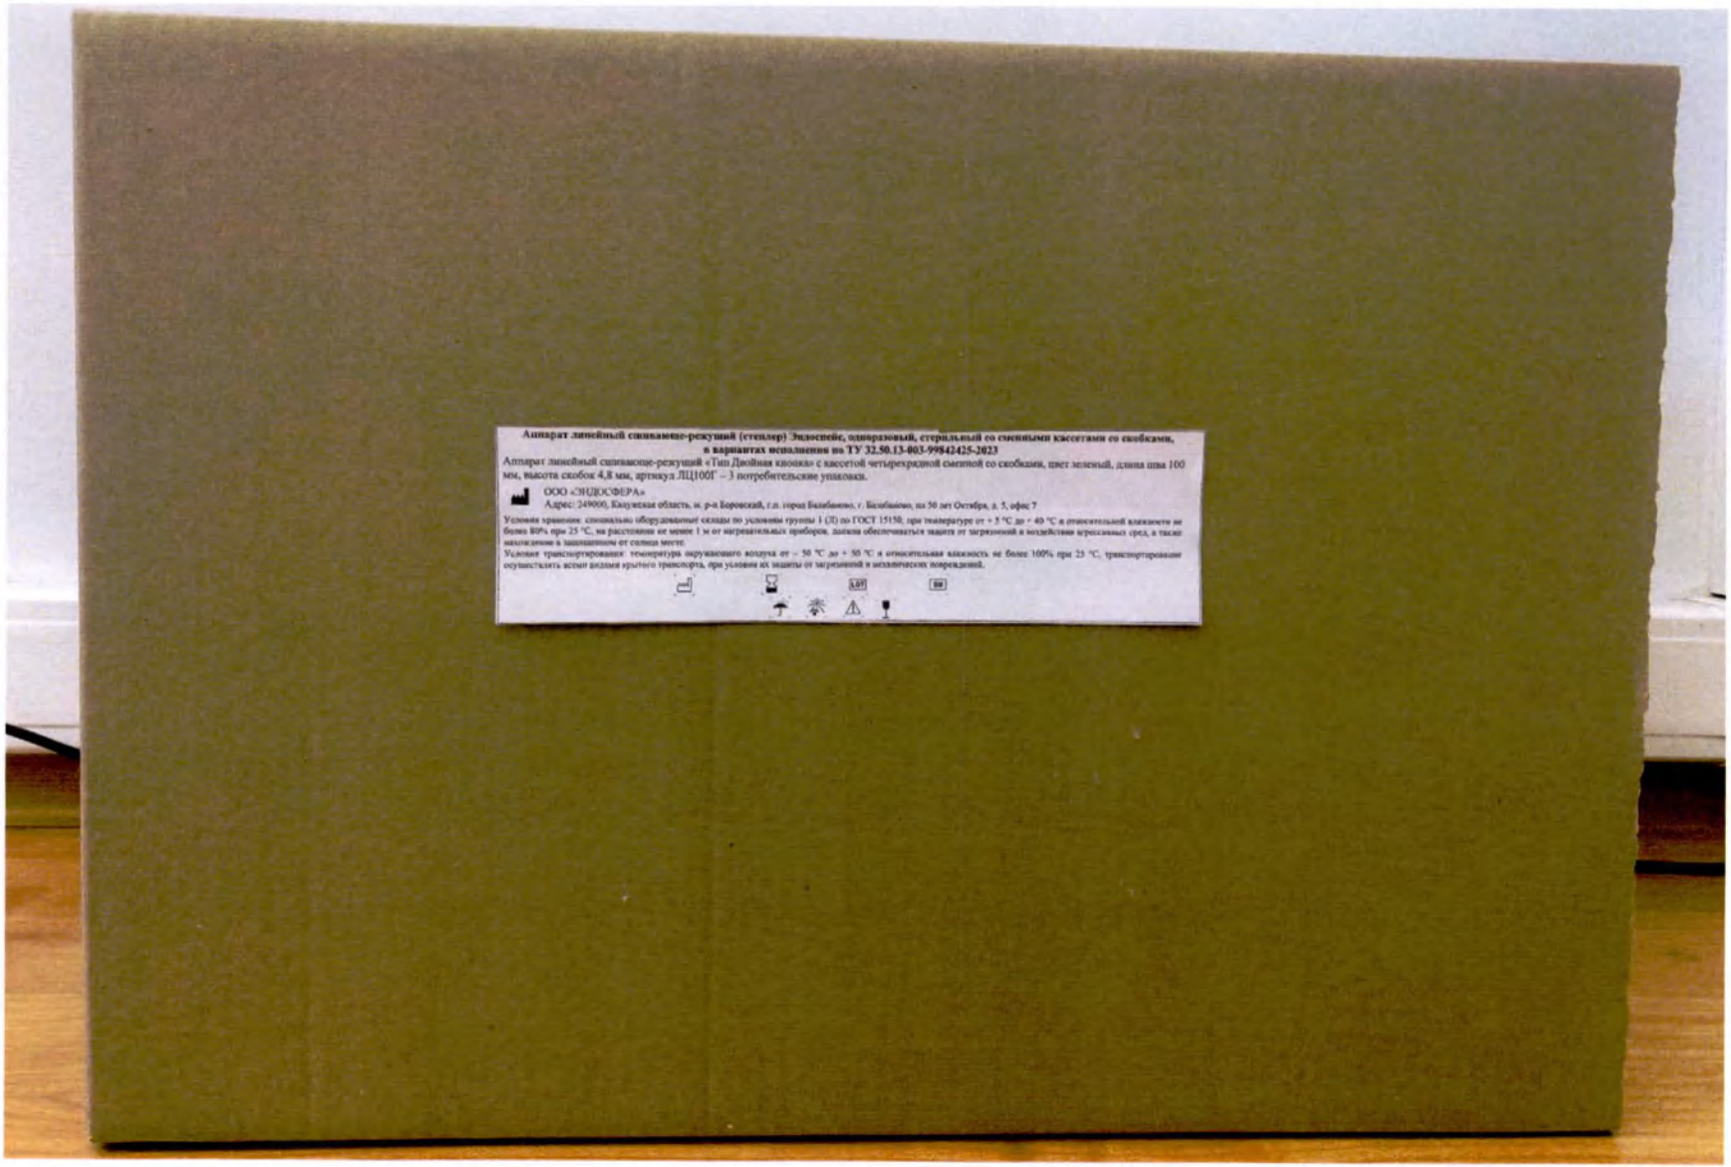

Рисунок 66 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейног сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

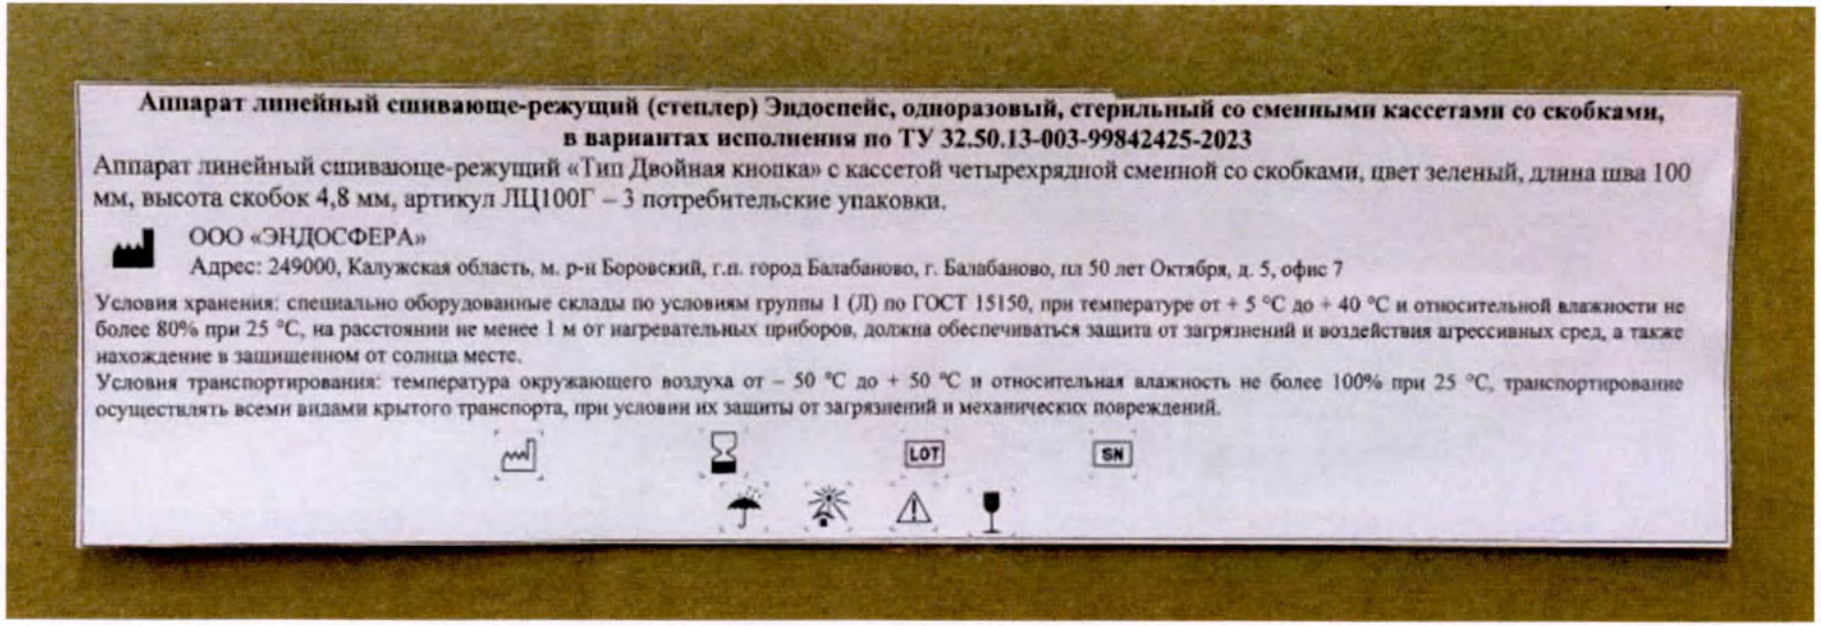

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

LOT SN

Рисунок 66А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейног сшивающе-режущего «Тип Двойная кнопка» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦ100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

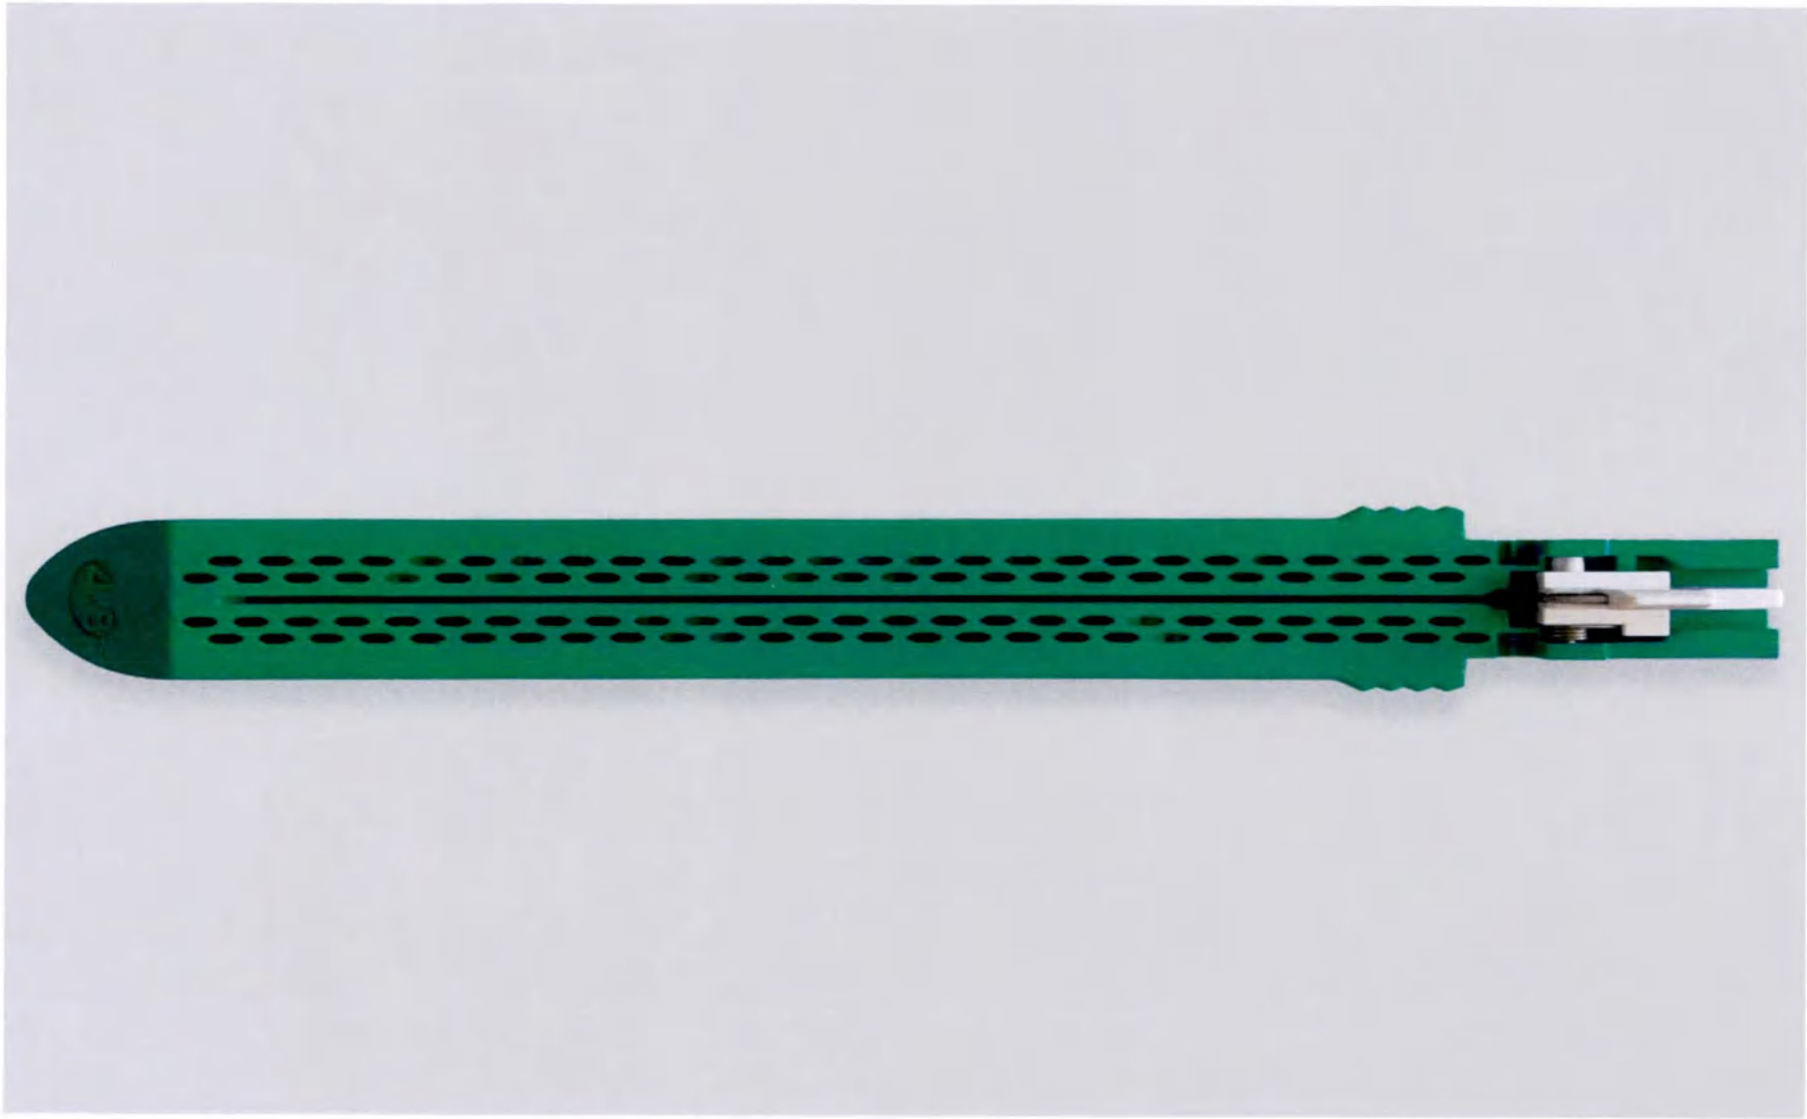

Рисунок 67 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

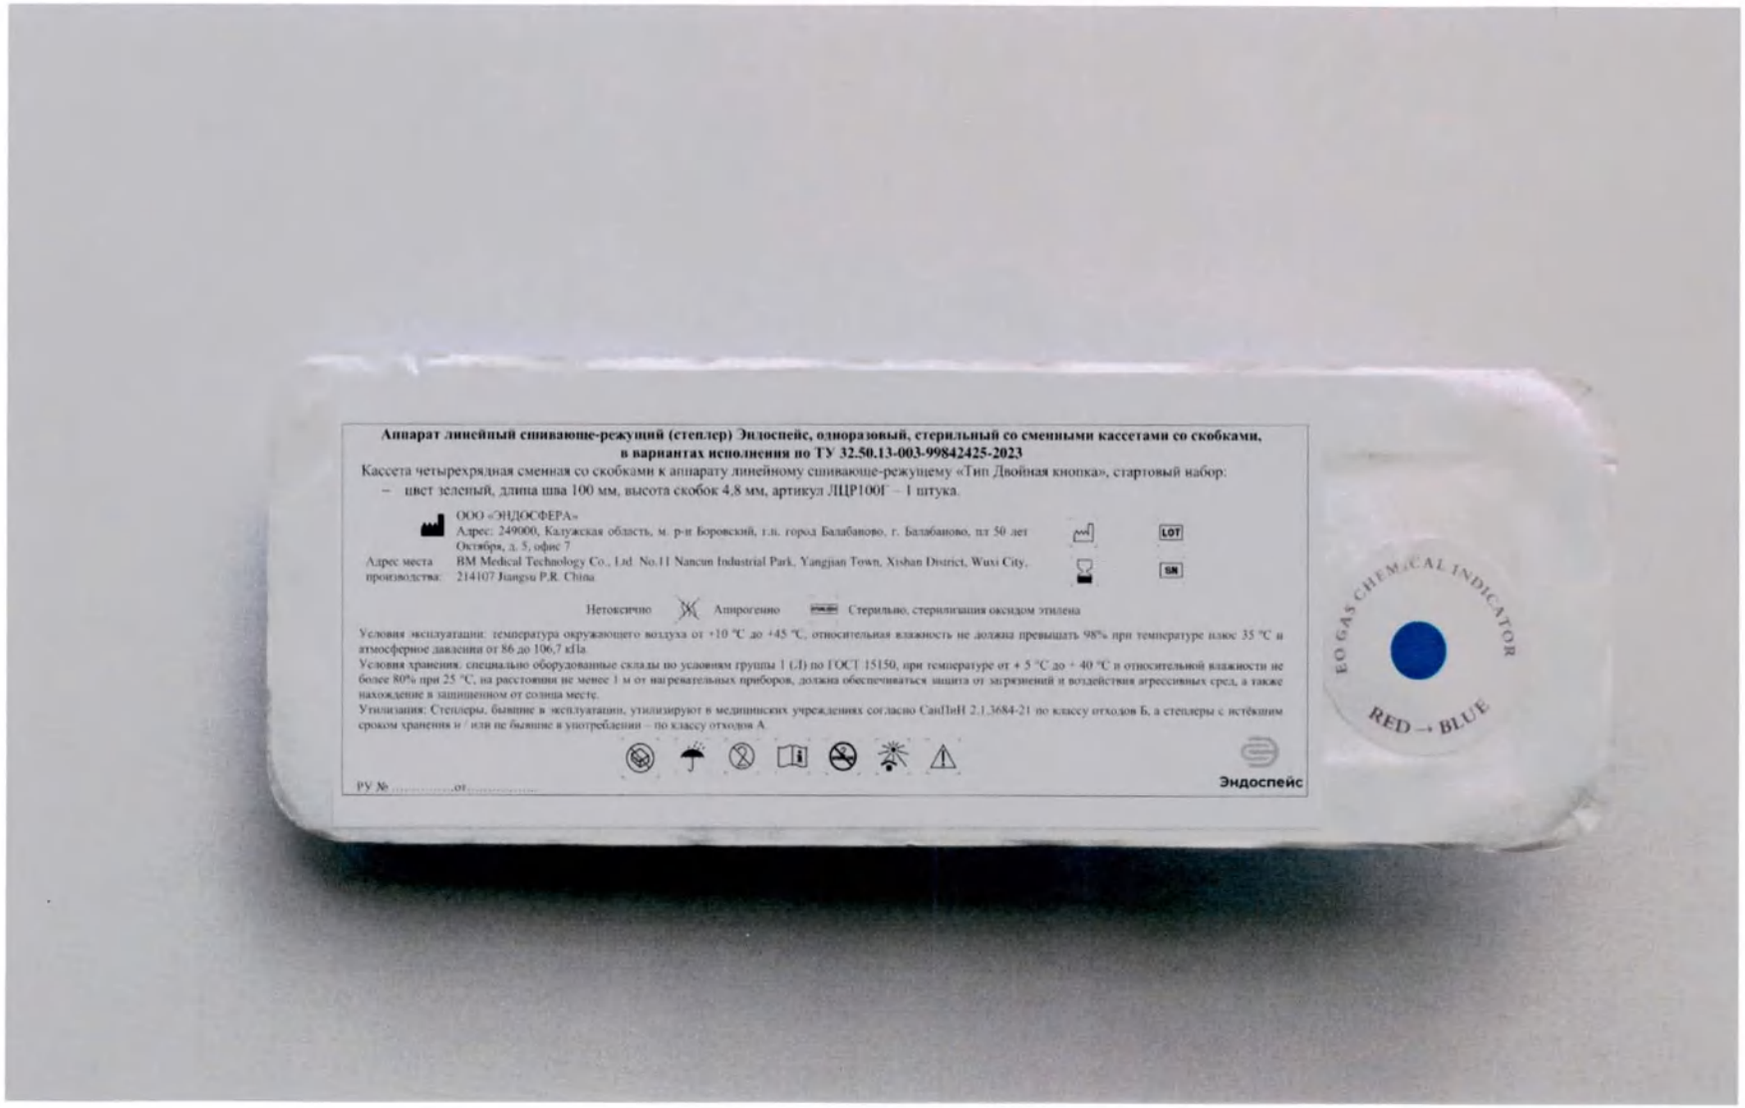

Рисунок 68 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 68А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

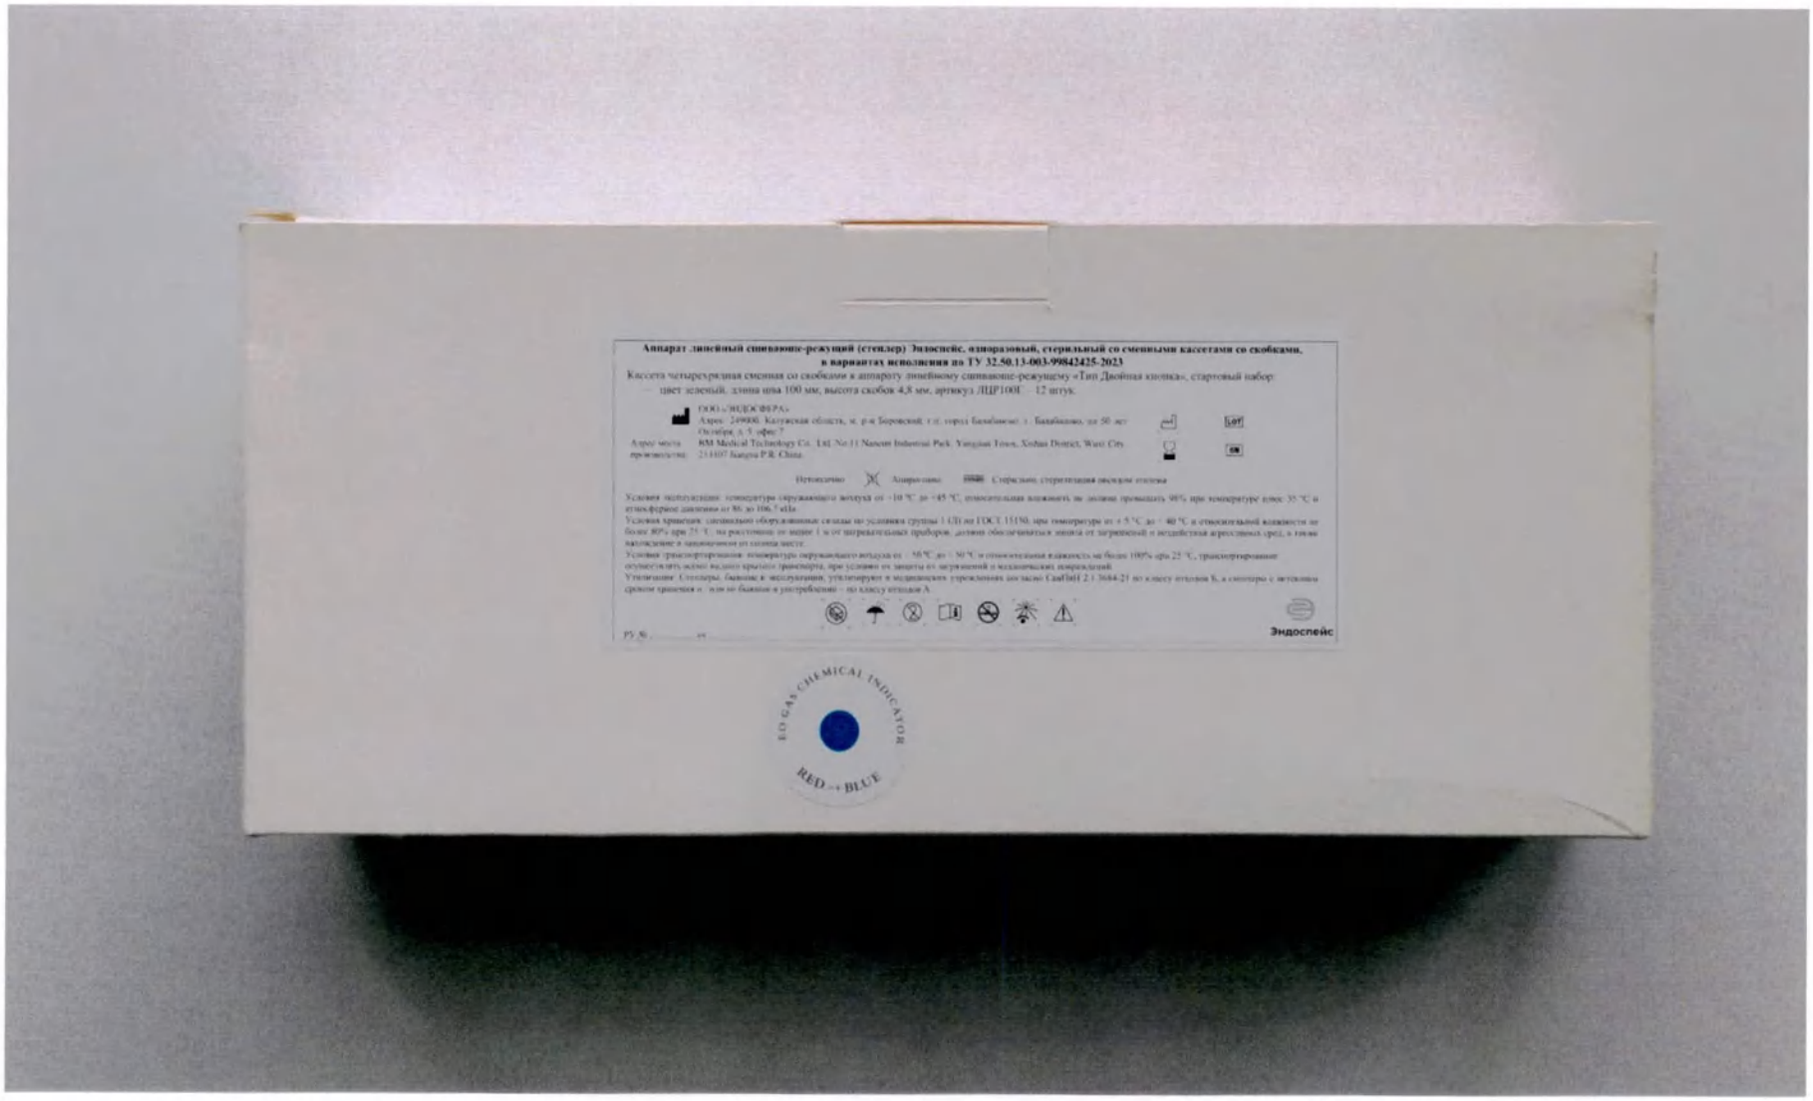

Рисунок 69 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

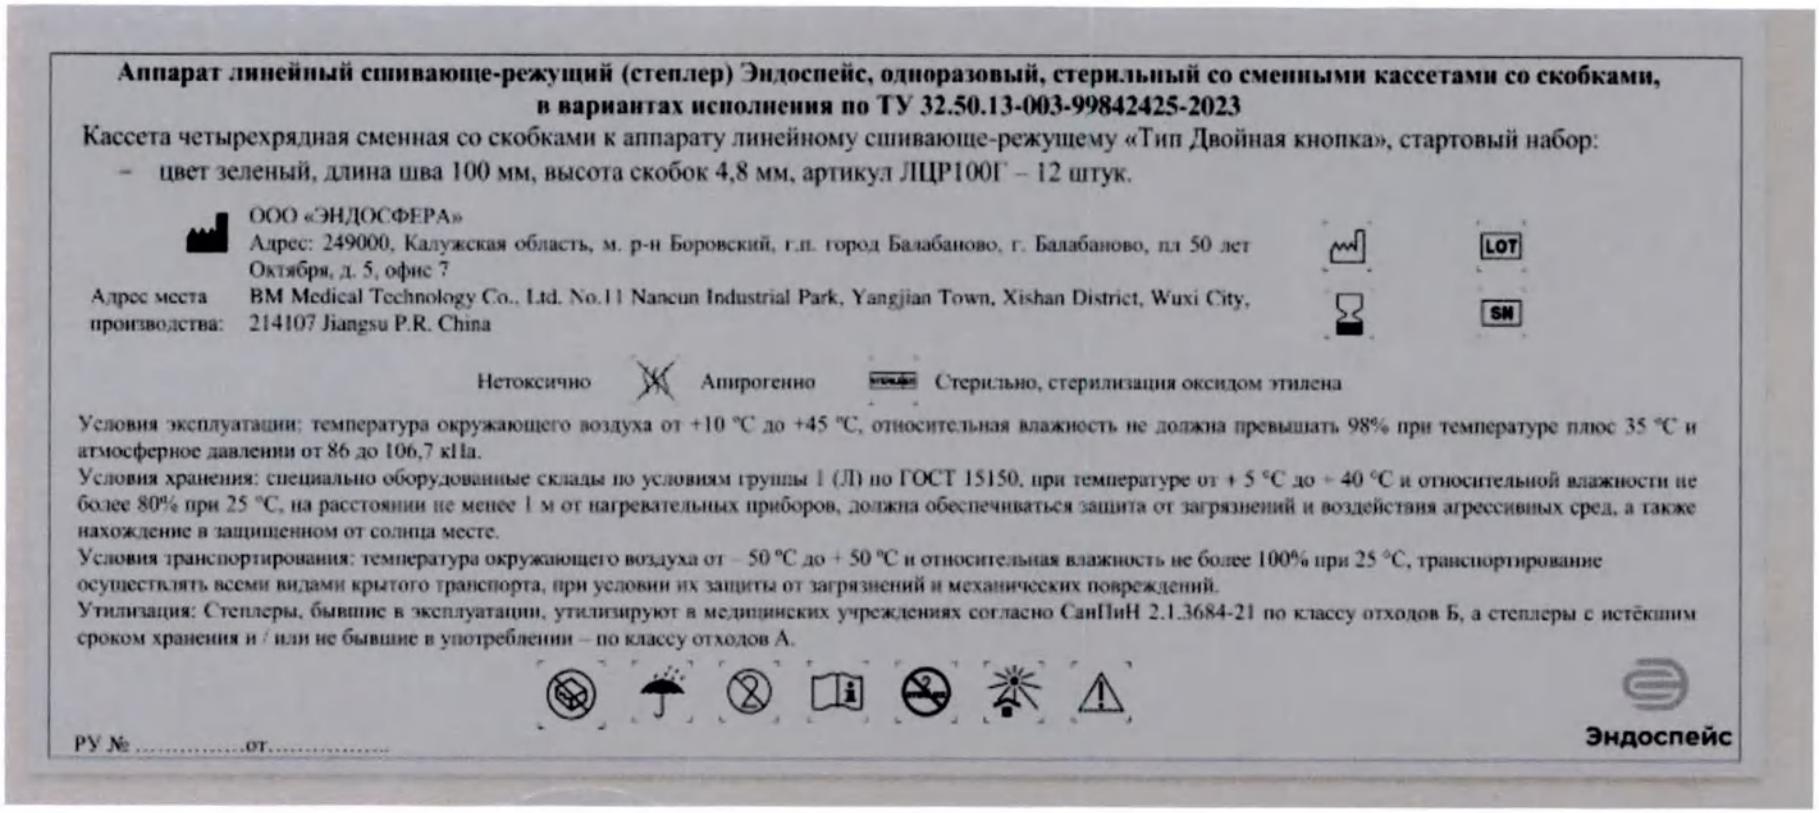

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 69А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

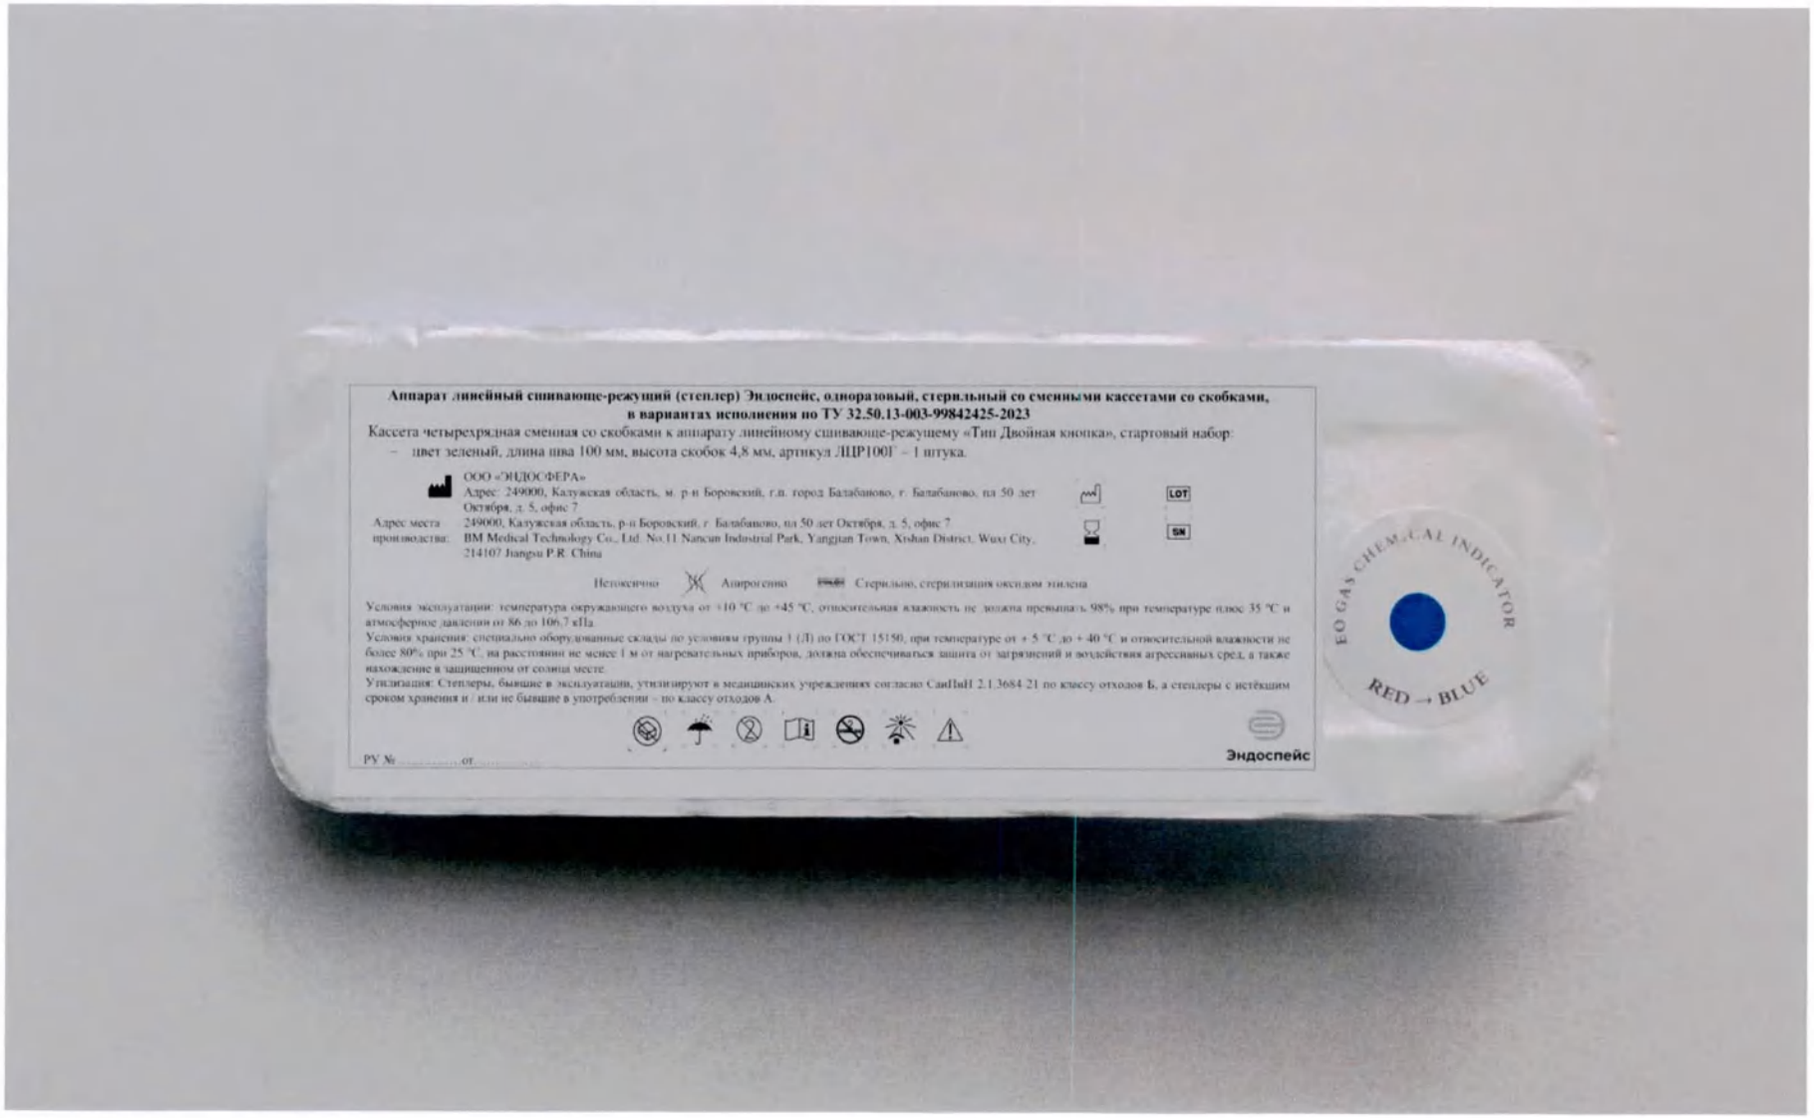

Рисунок 70 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 70А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

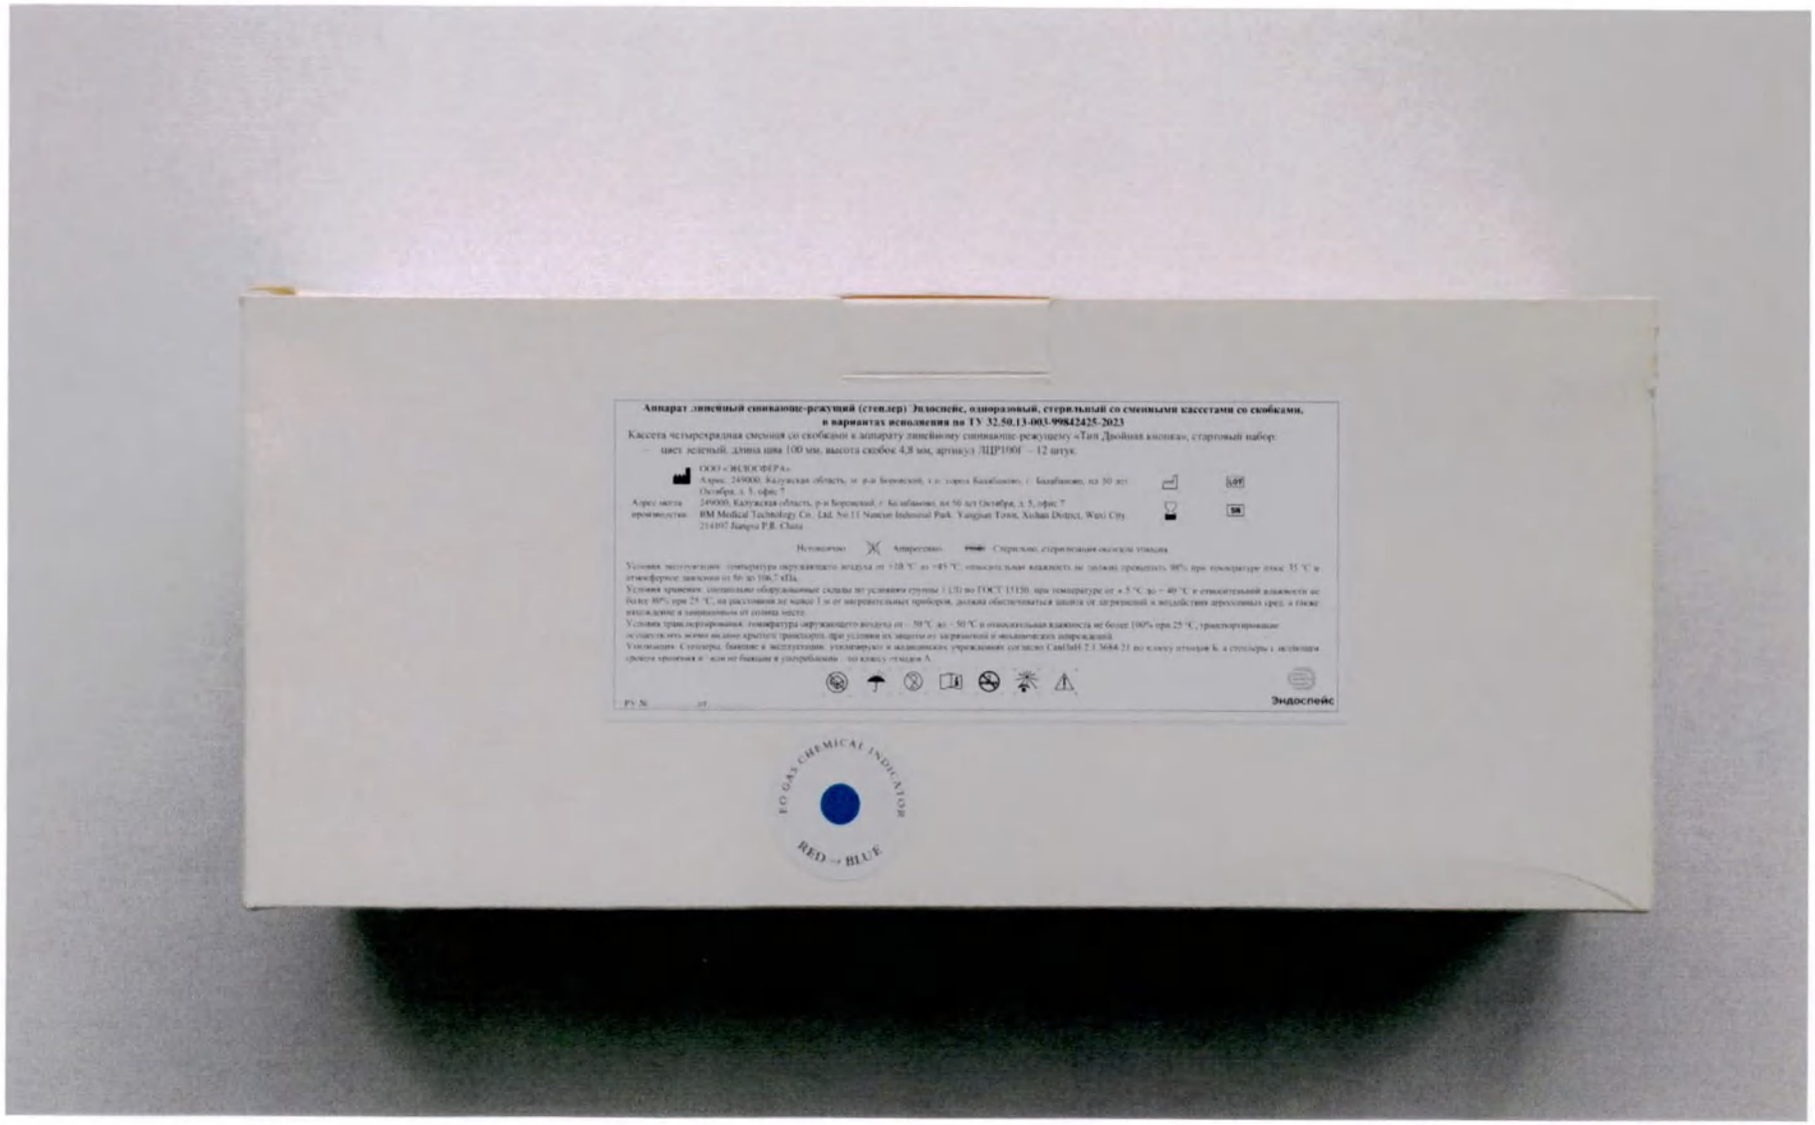

Рисунок 71 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г – 12 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 71А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 72 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

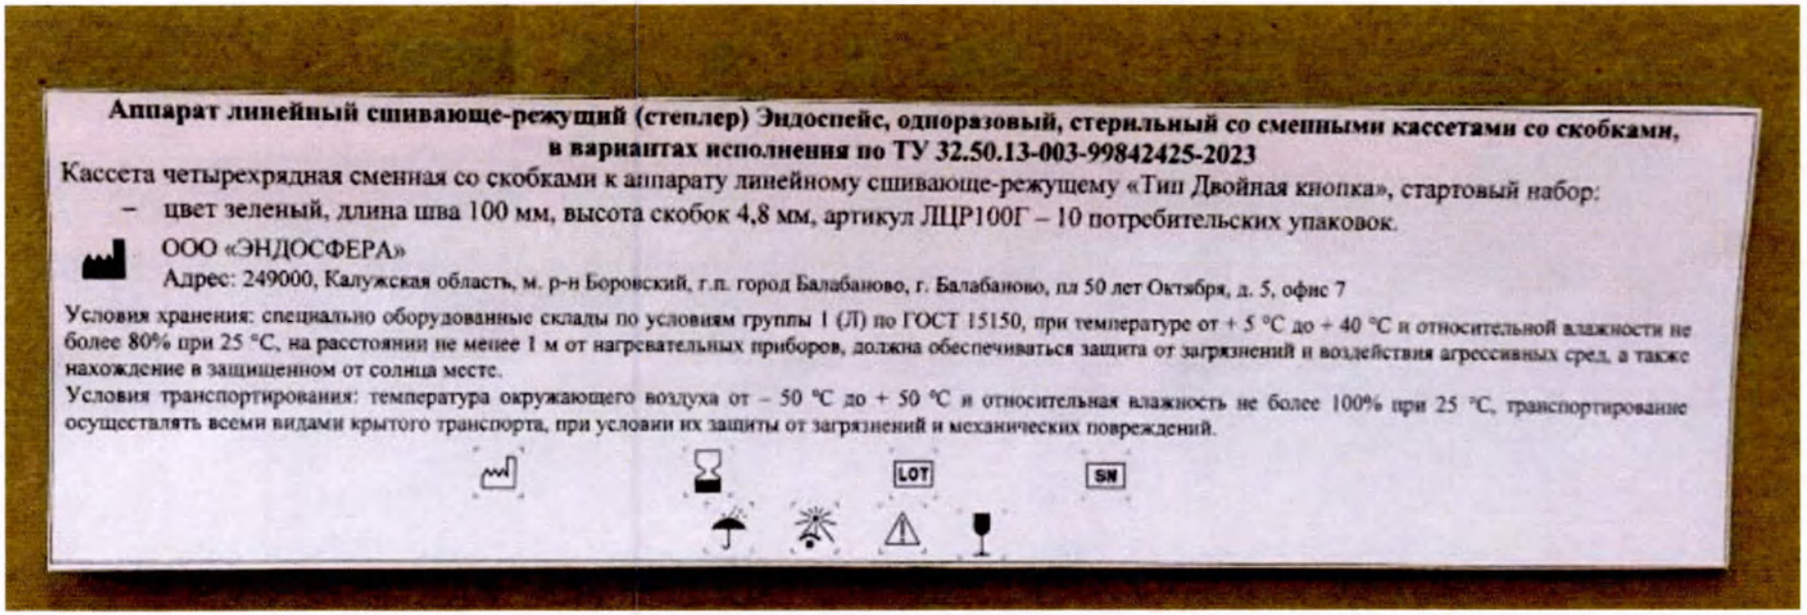

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 72А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему «Тип Двойная кнопка», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 100 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛЦР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

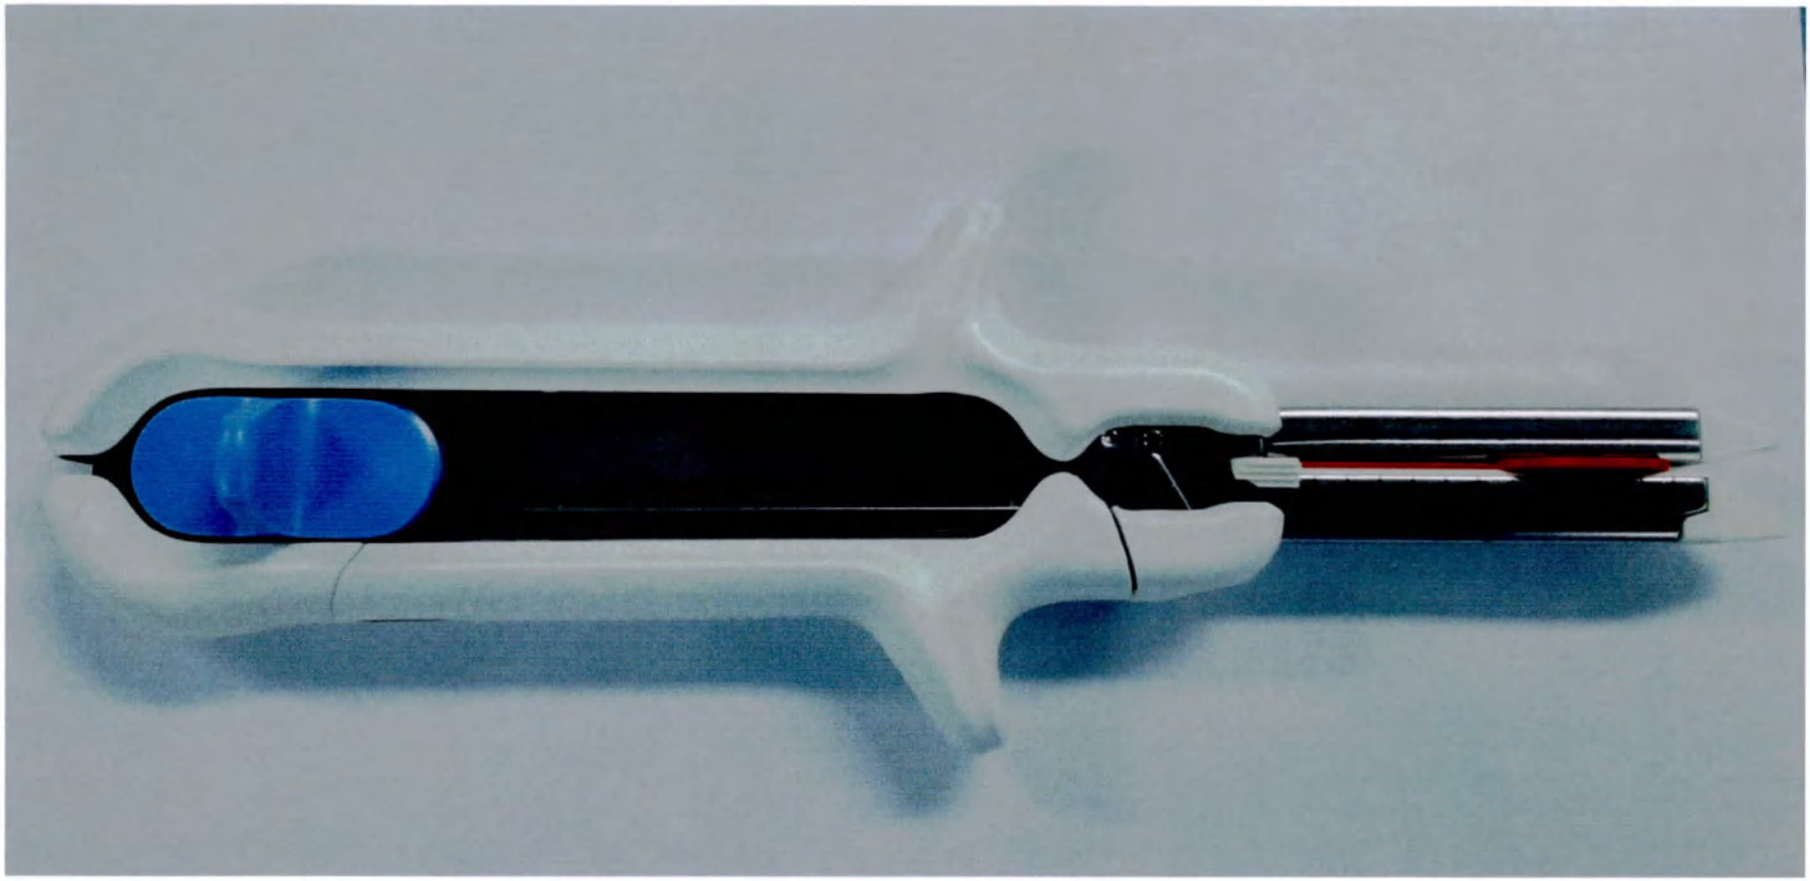

Рисунок 73 – Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 74 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 74А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

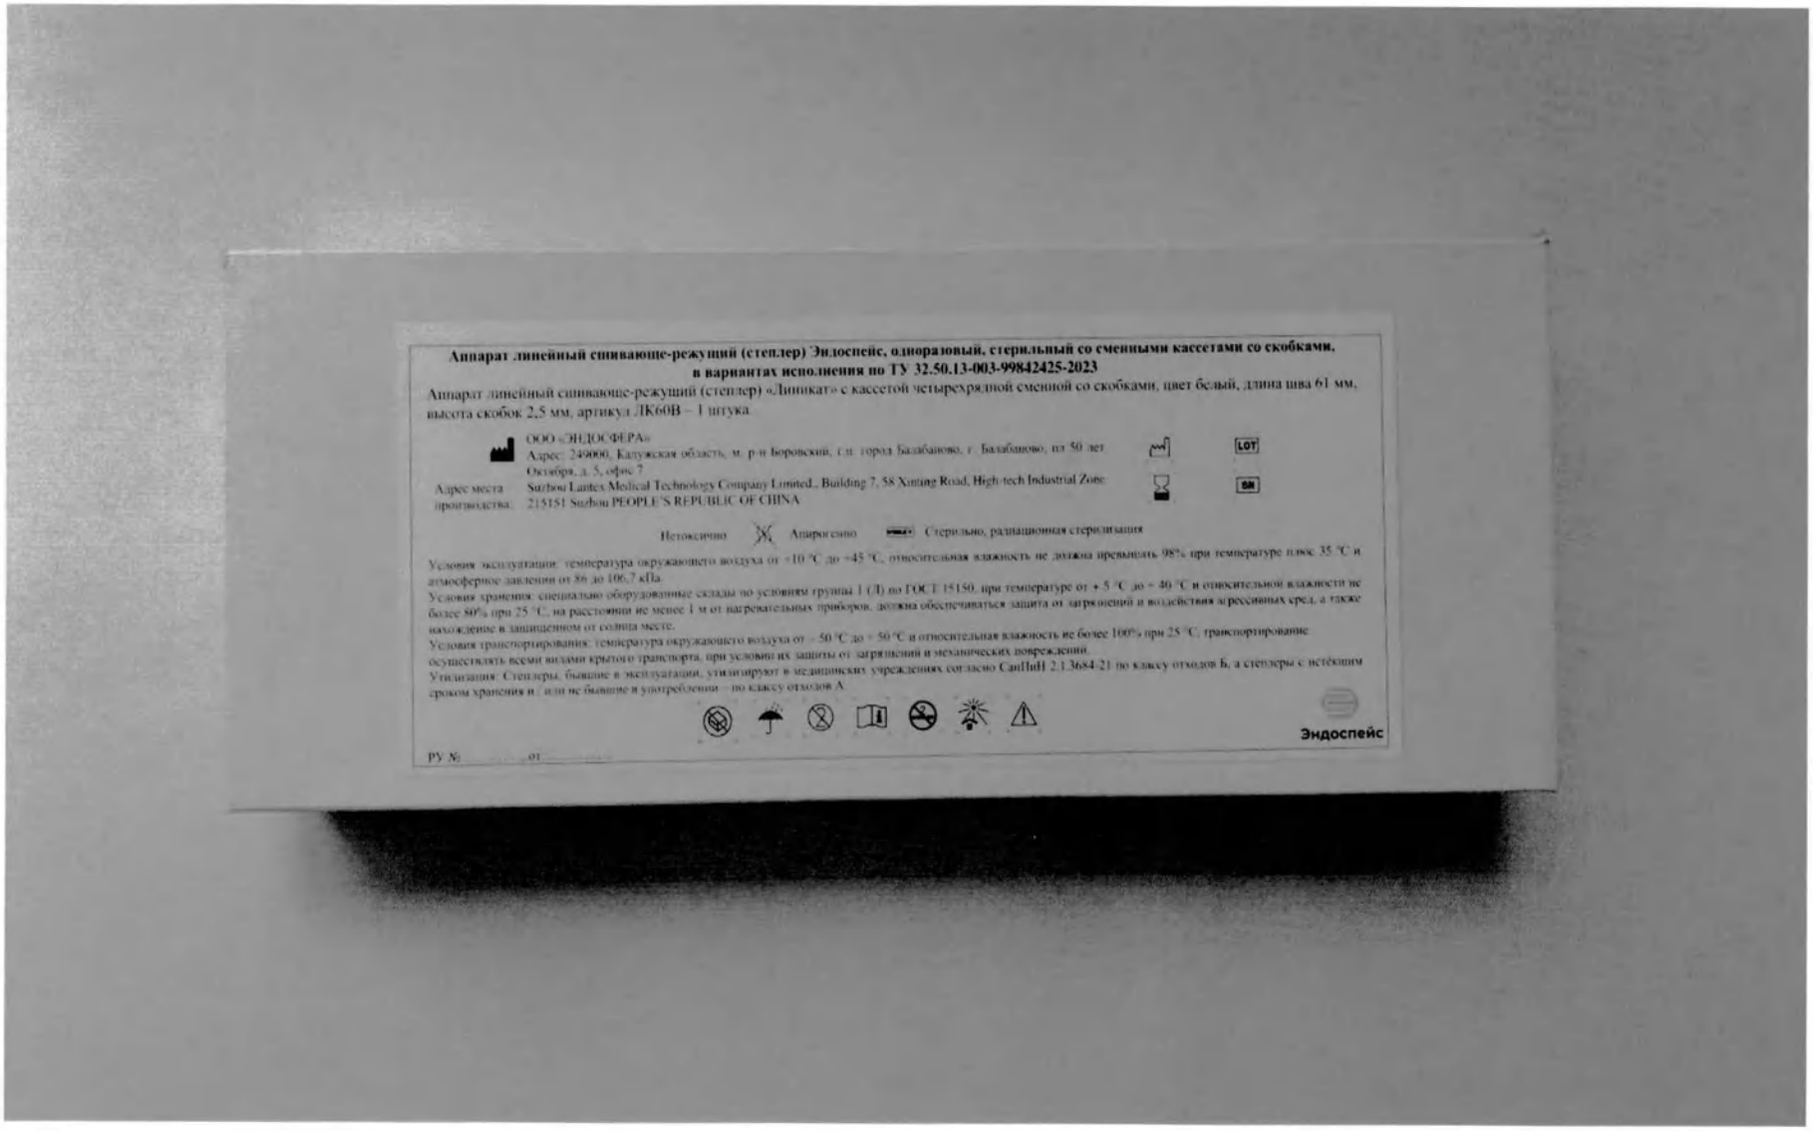

Рисунок 75 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 75А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

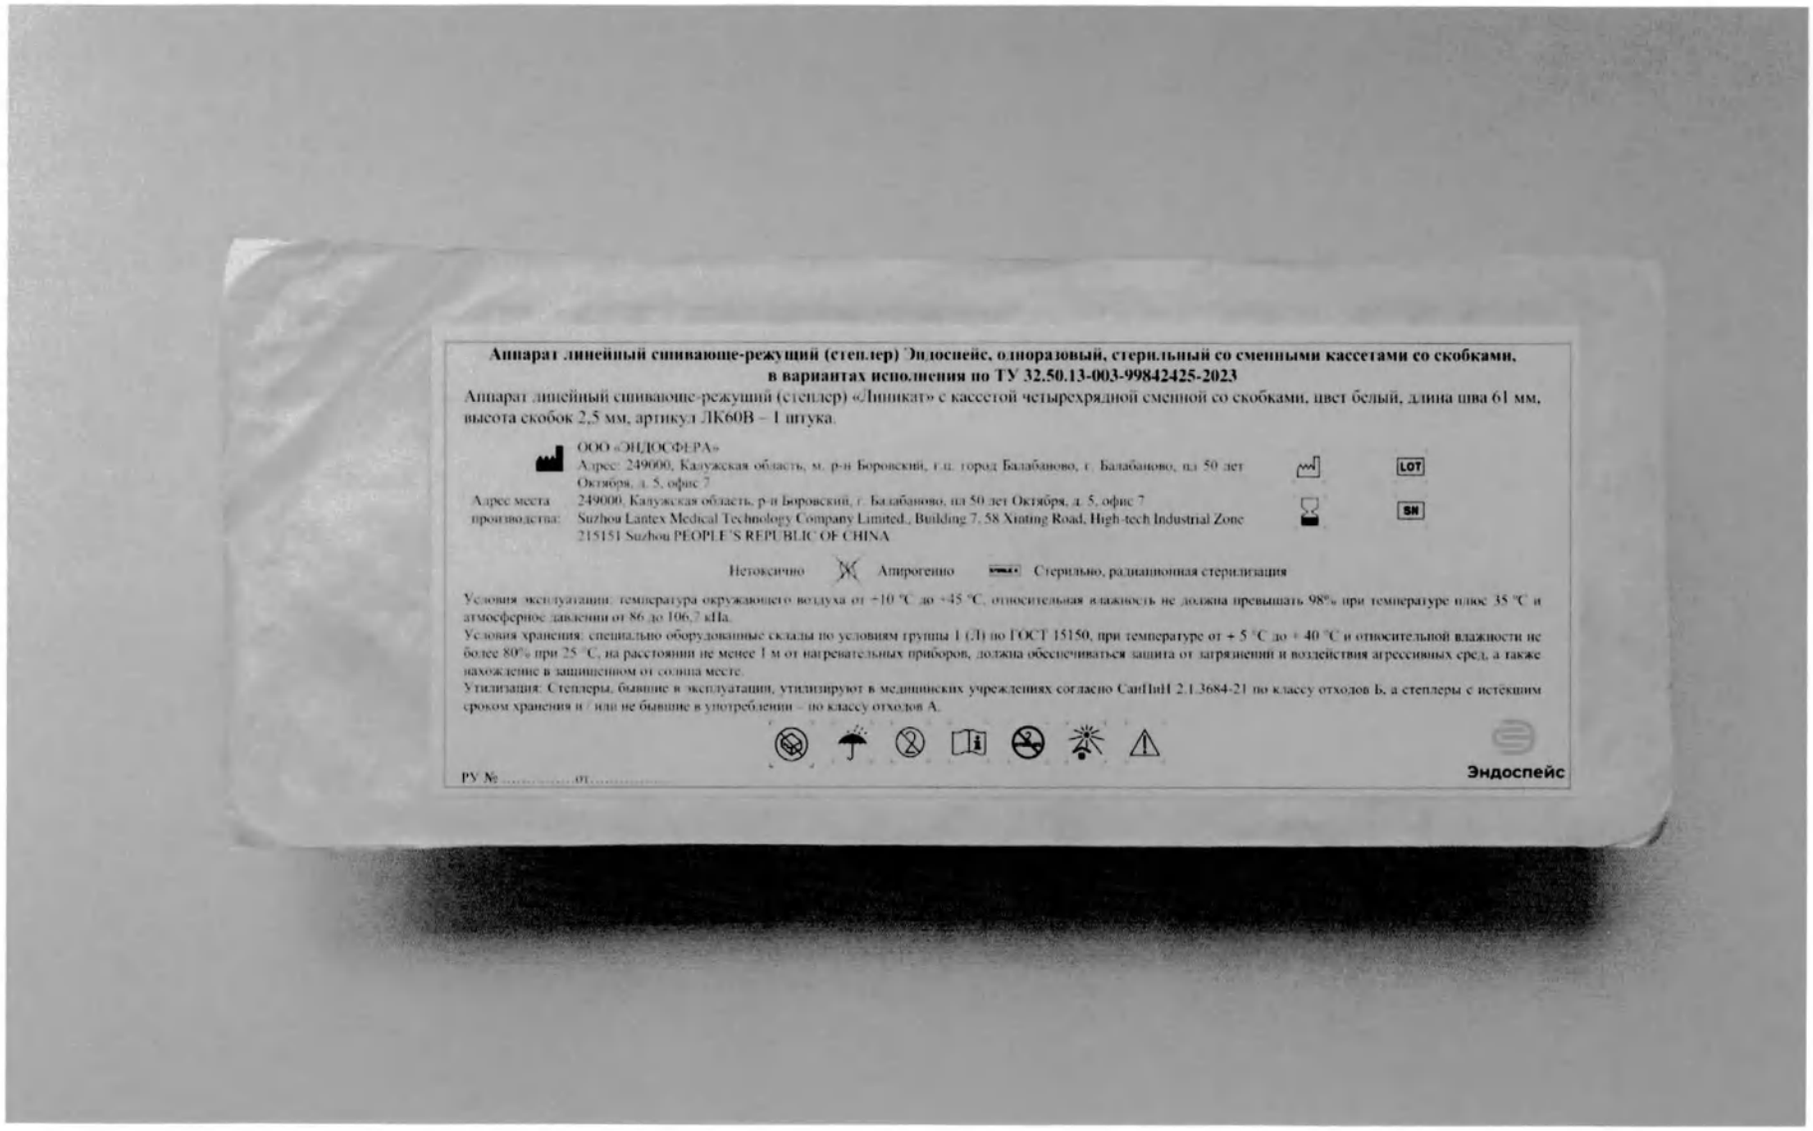

Рисунок 76 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 76А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

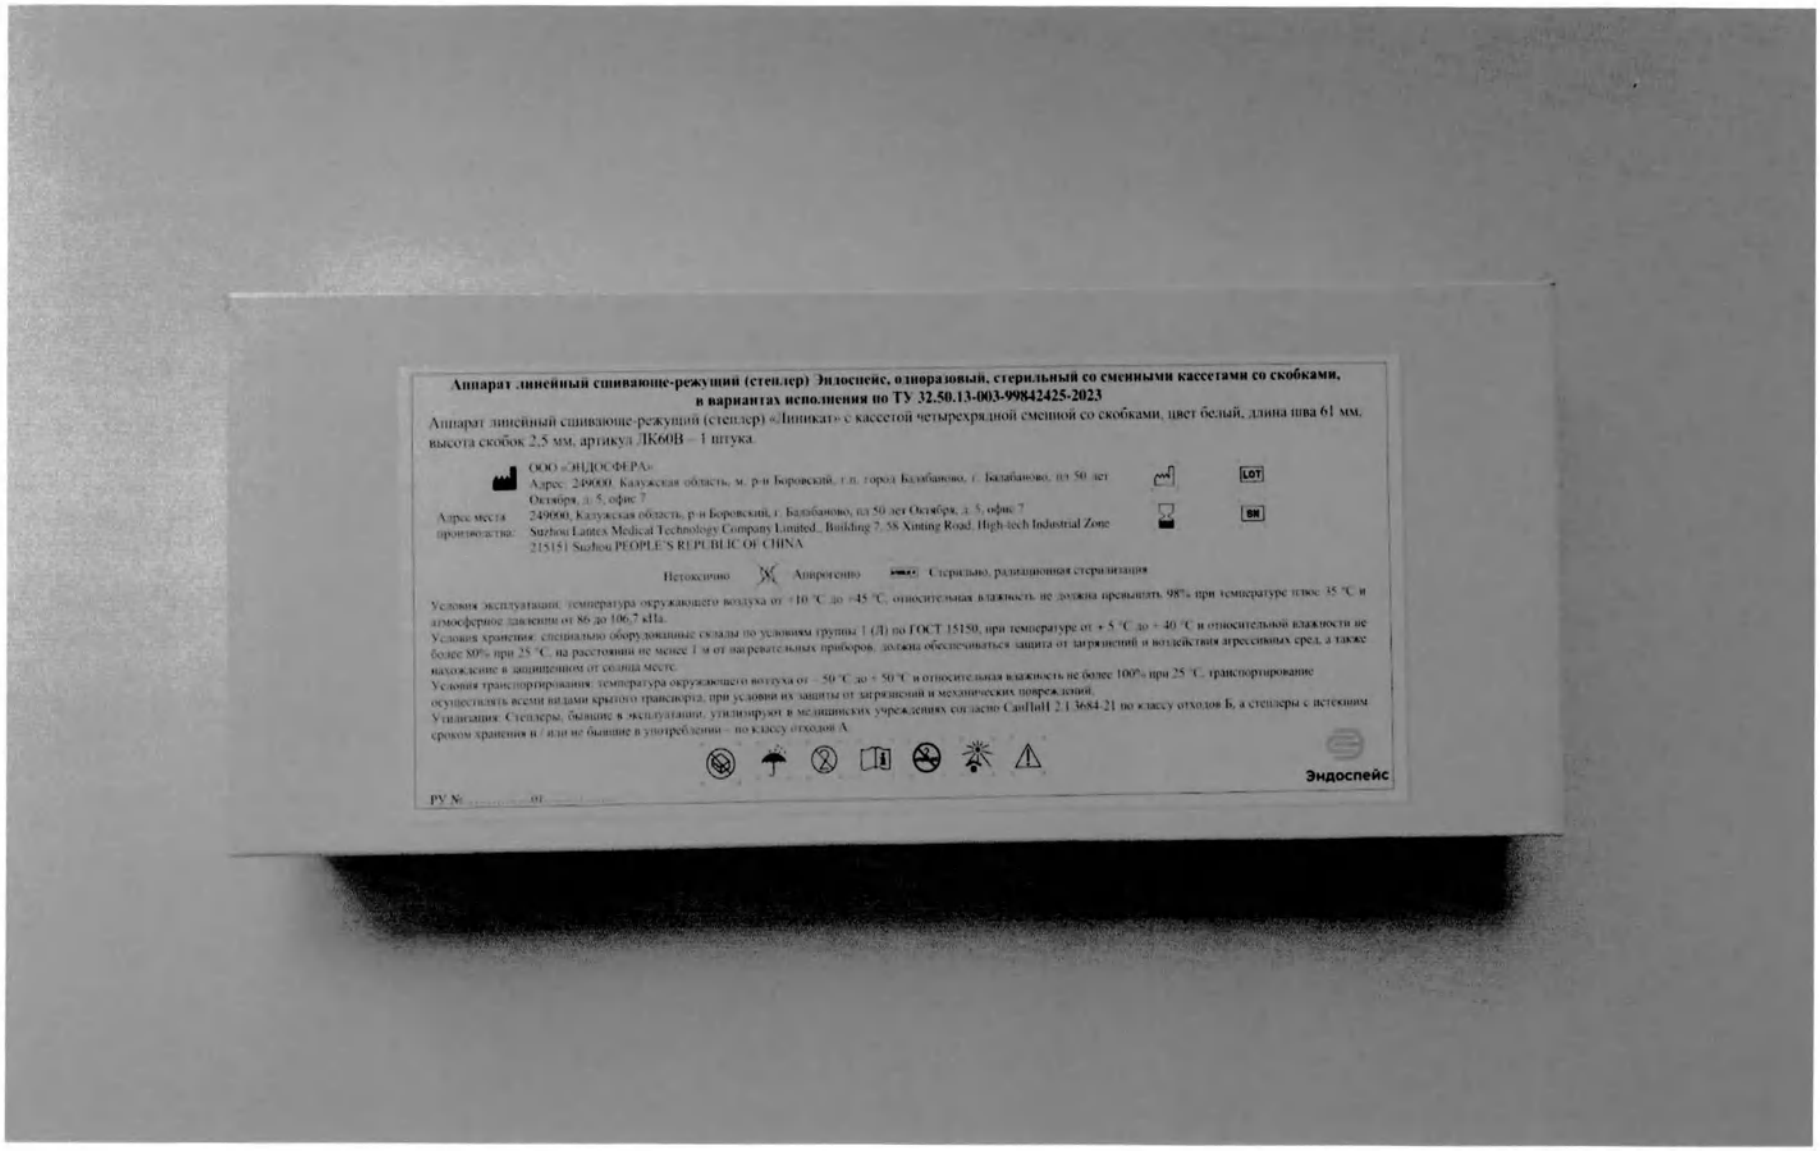

Рисунок 77 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 77А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 78 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

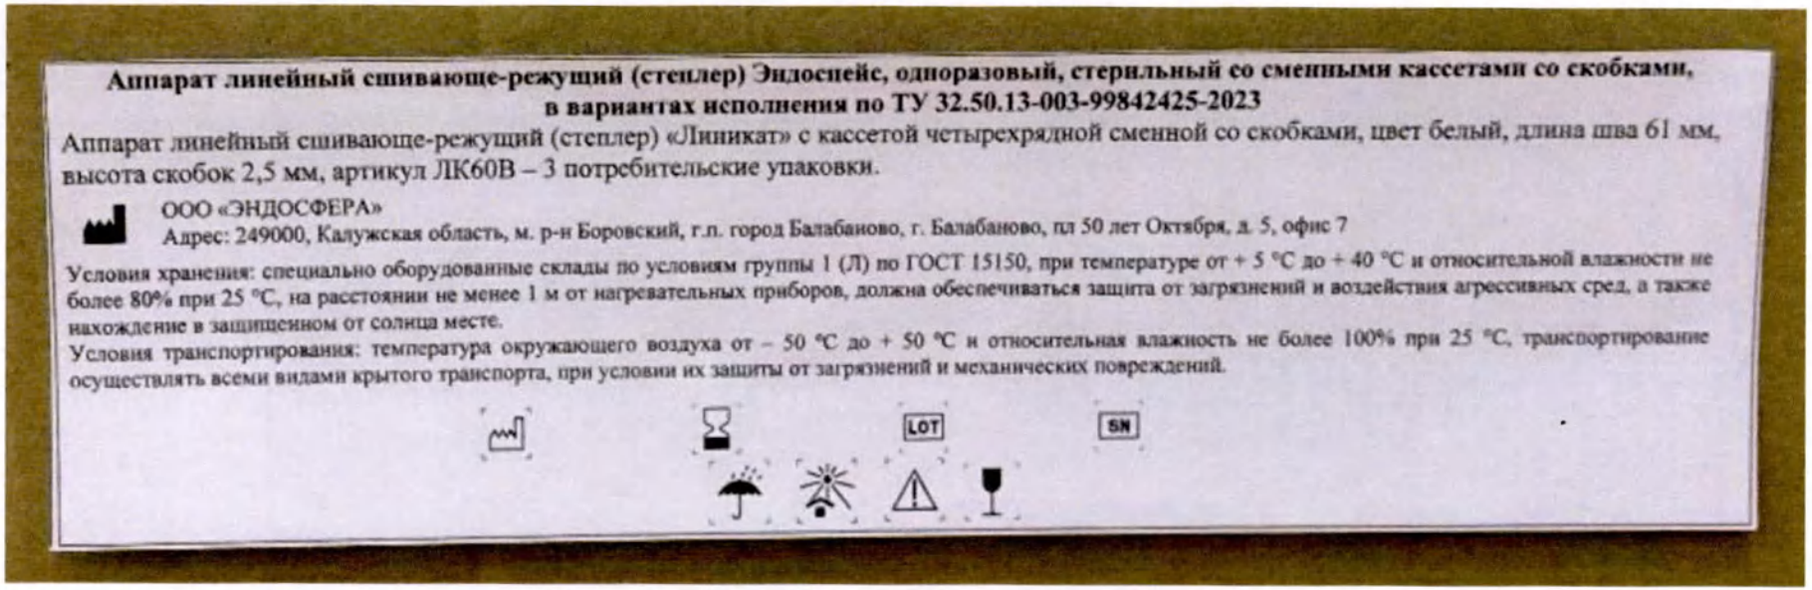

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 78А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛК60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

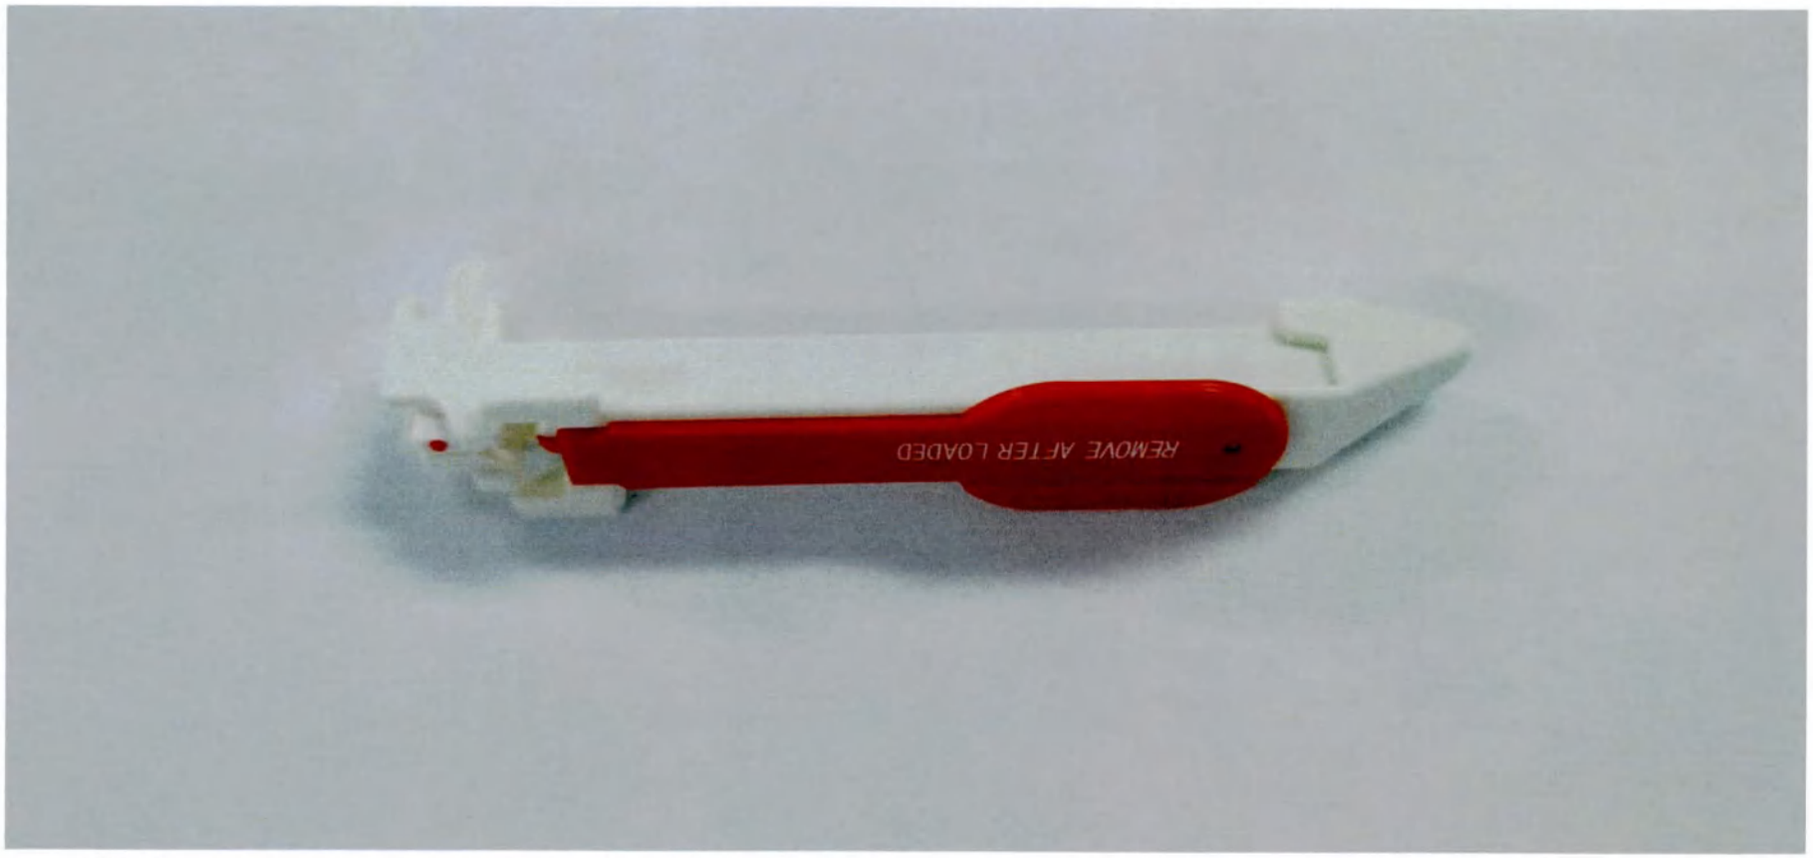

Рисунок 79 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 80 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

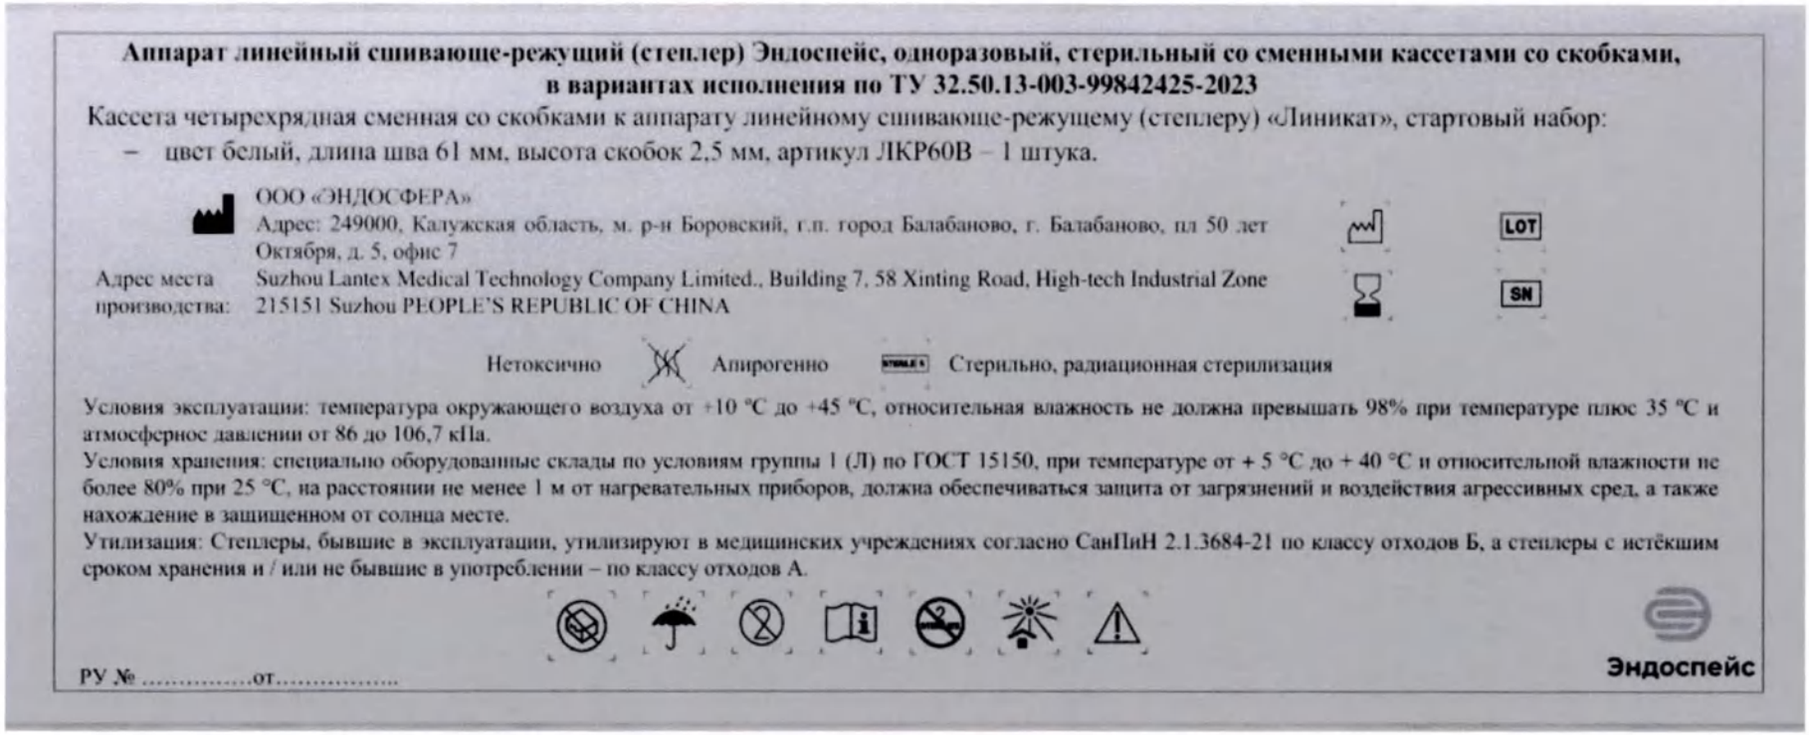

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 80А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 81 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

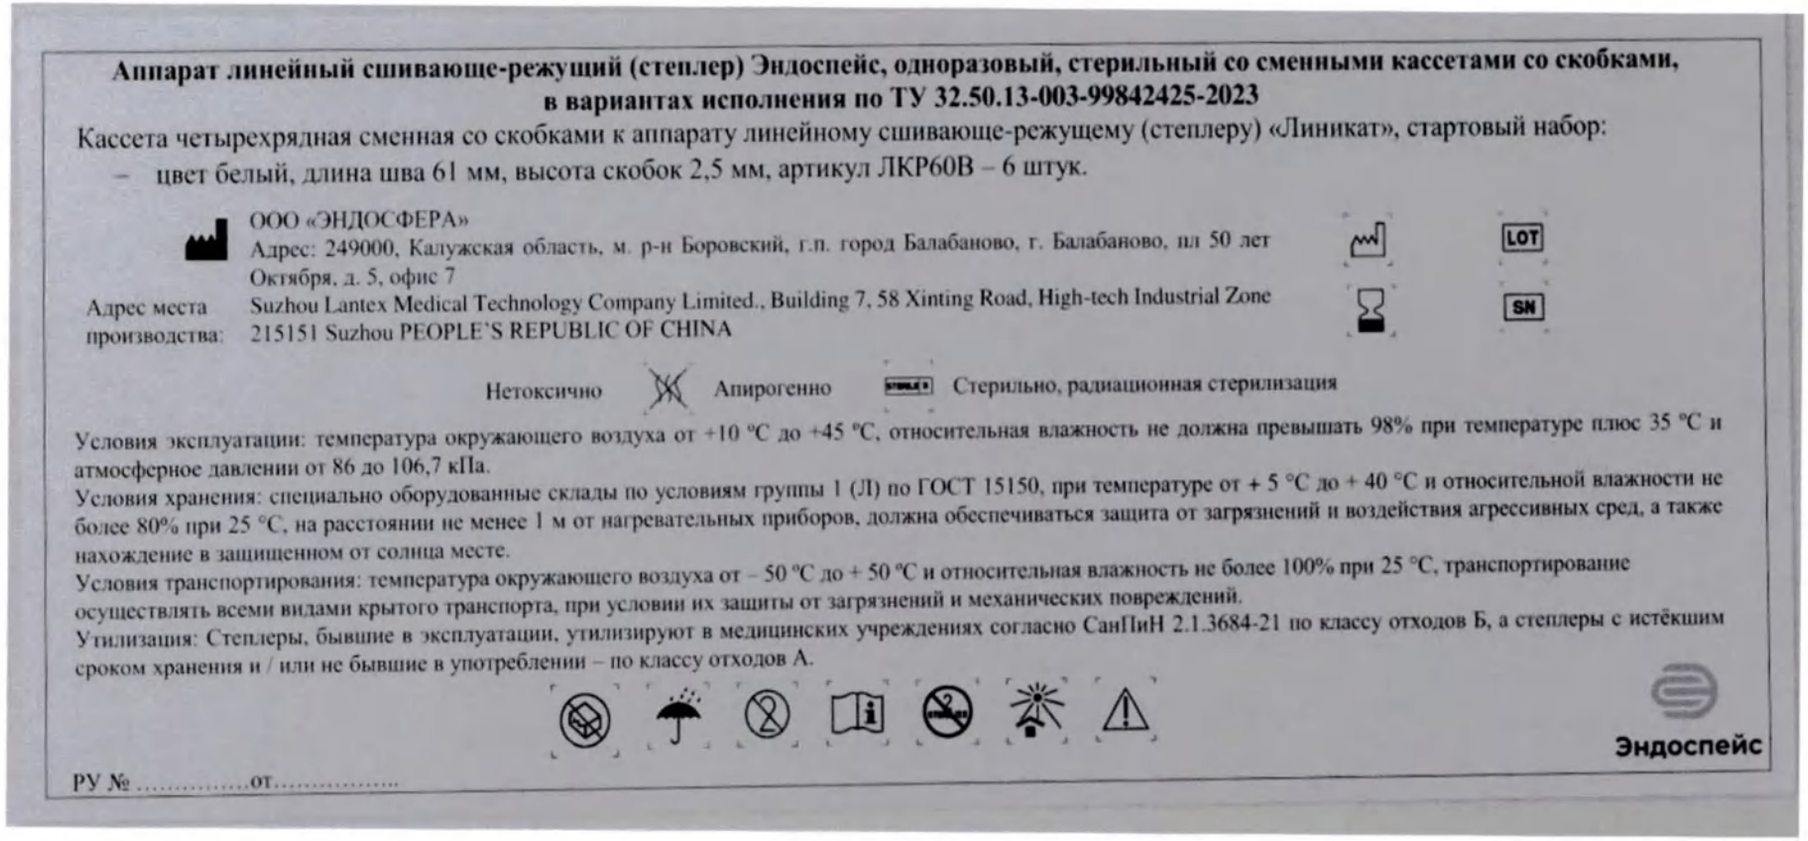

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 81А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

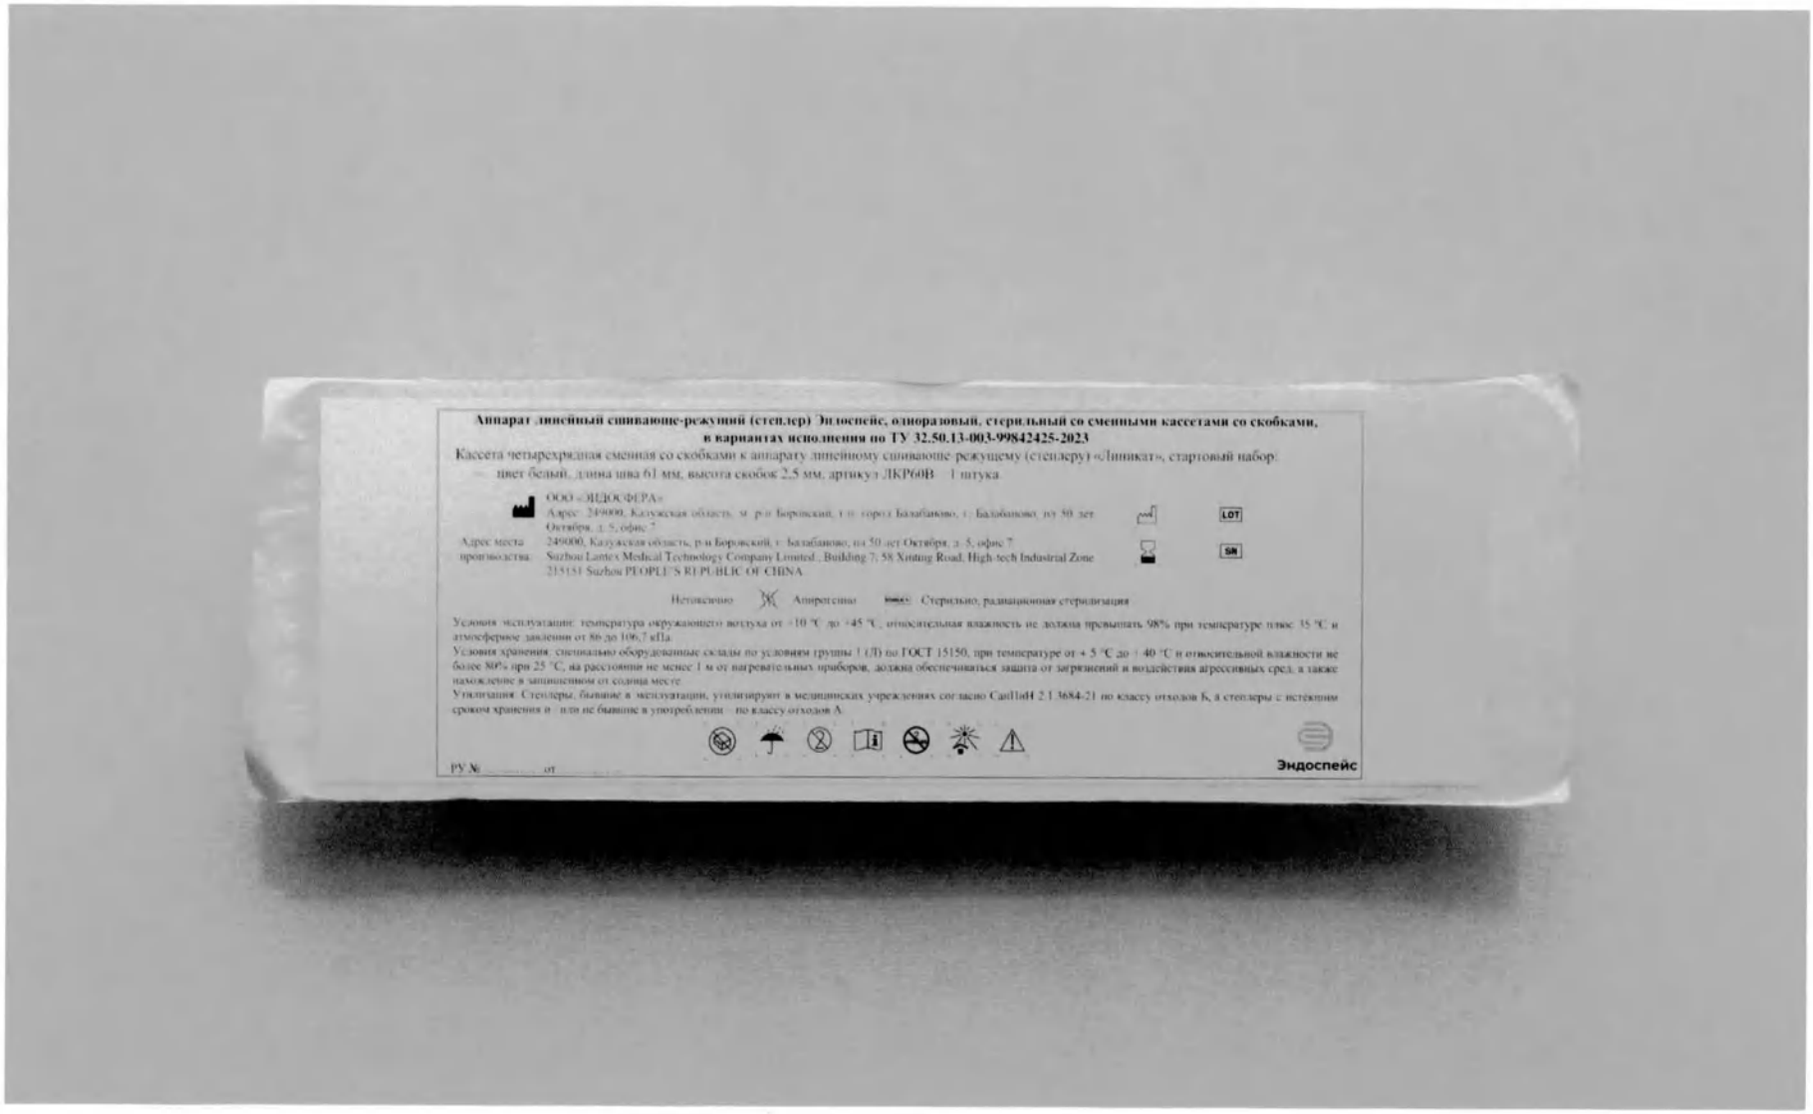

Рисунок 82 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

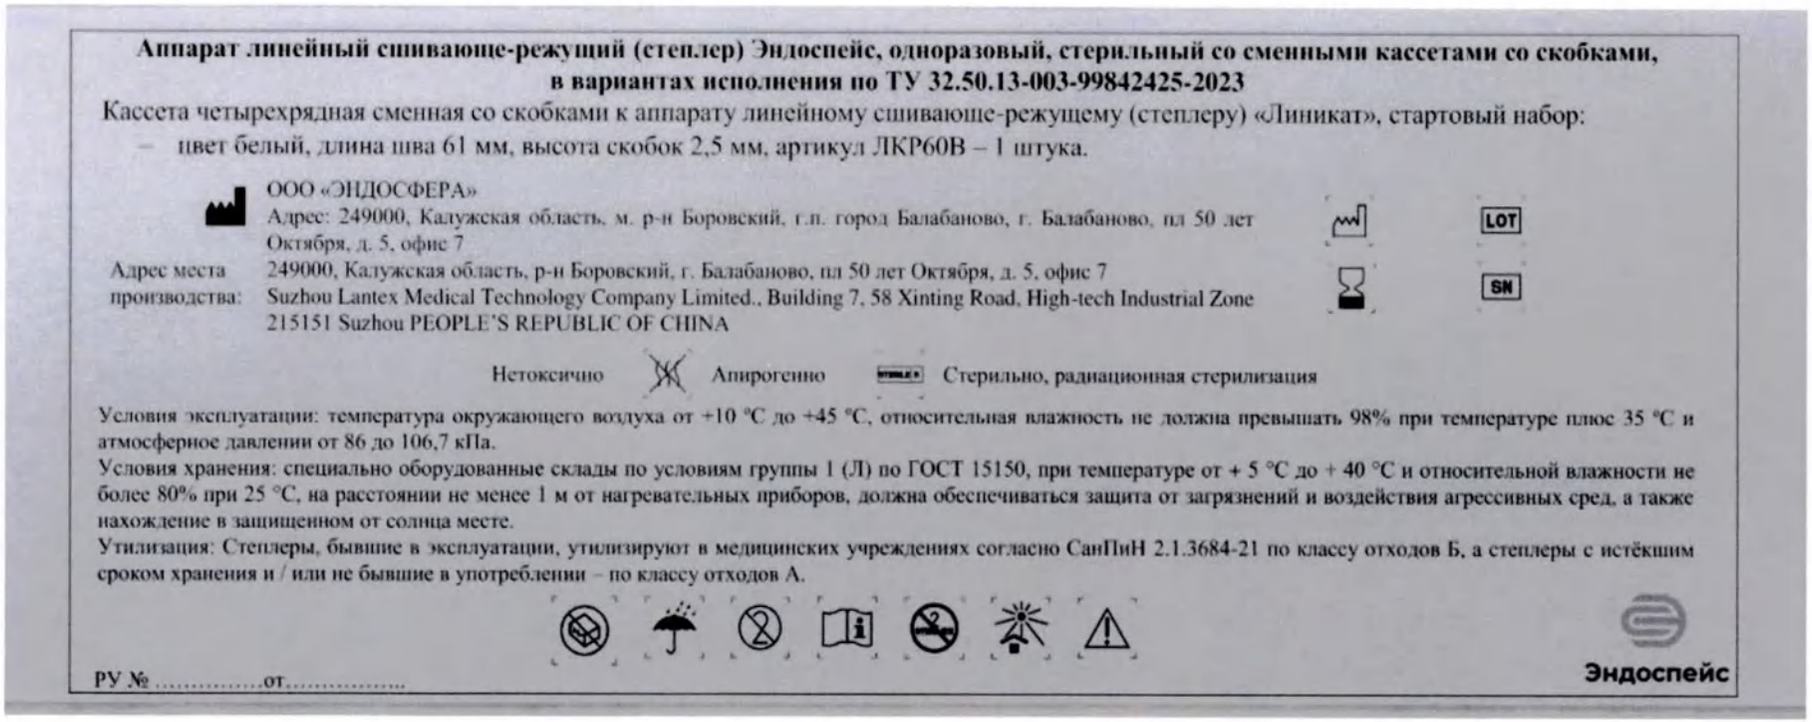

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 82А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 83 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

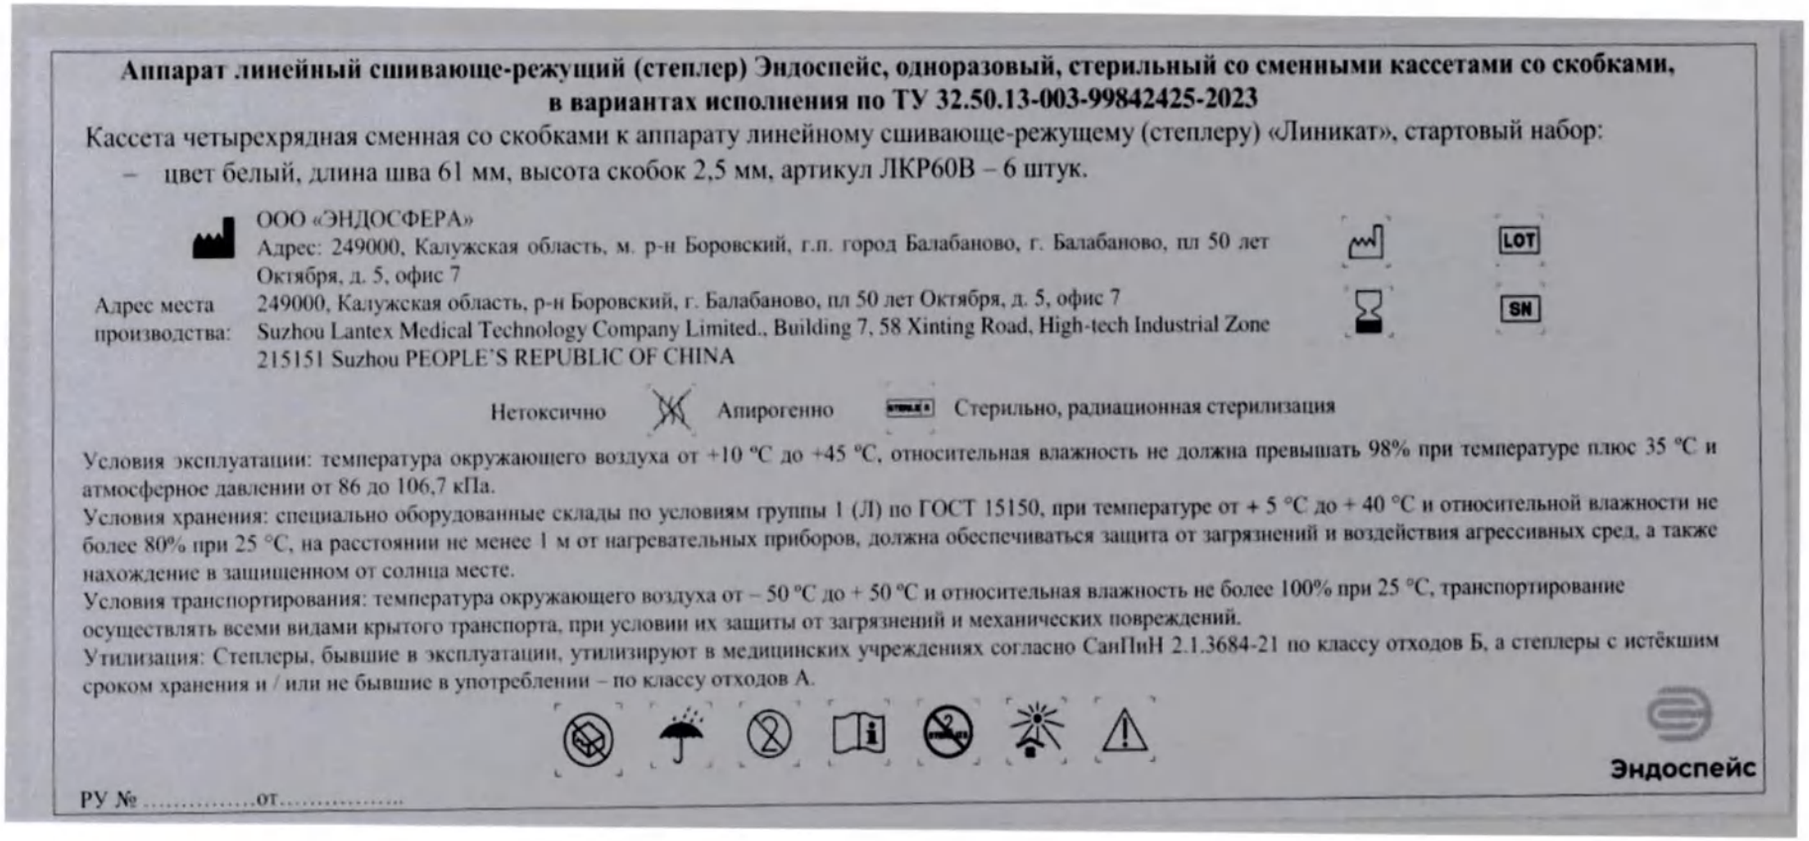

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 83А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 84 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

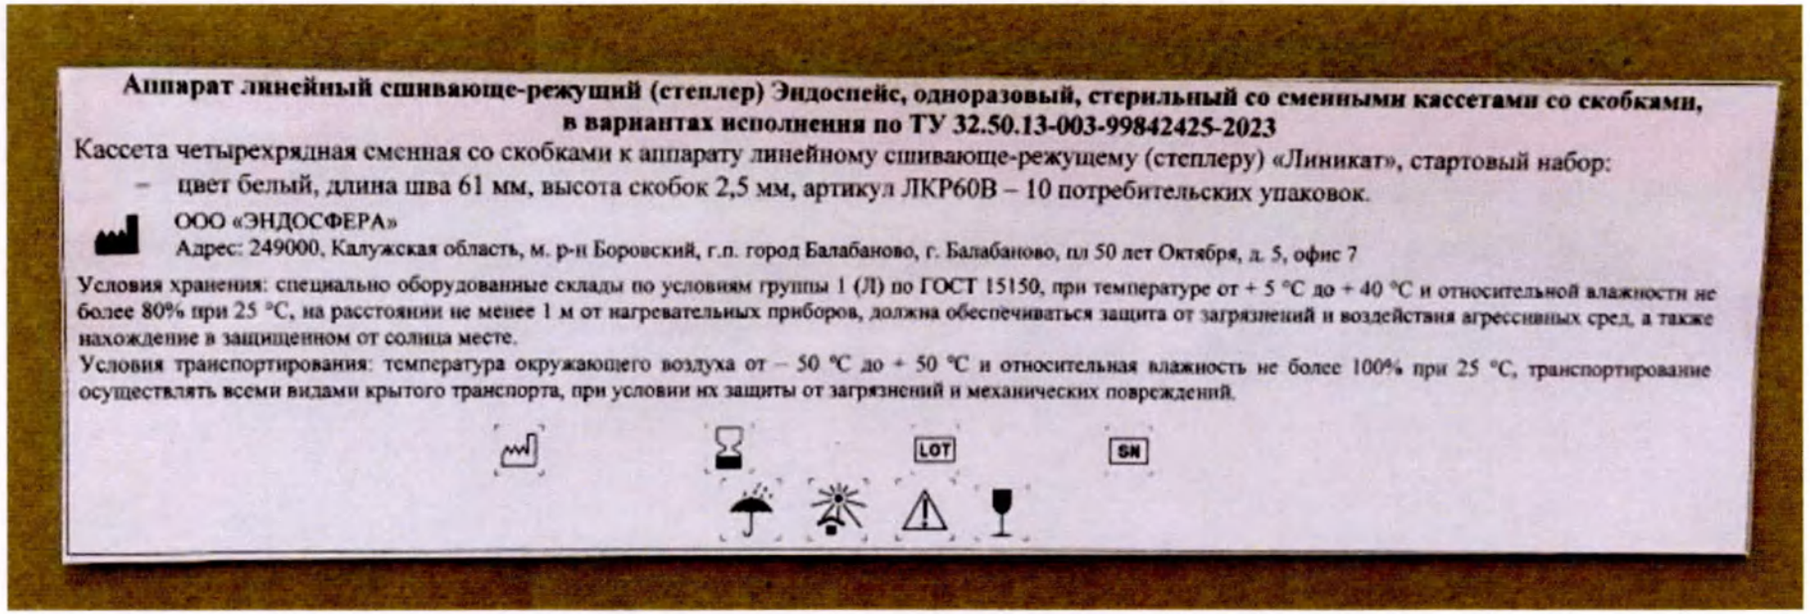

Рисунок 84А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет белый, длина шва 61 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ЛКР60В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

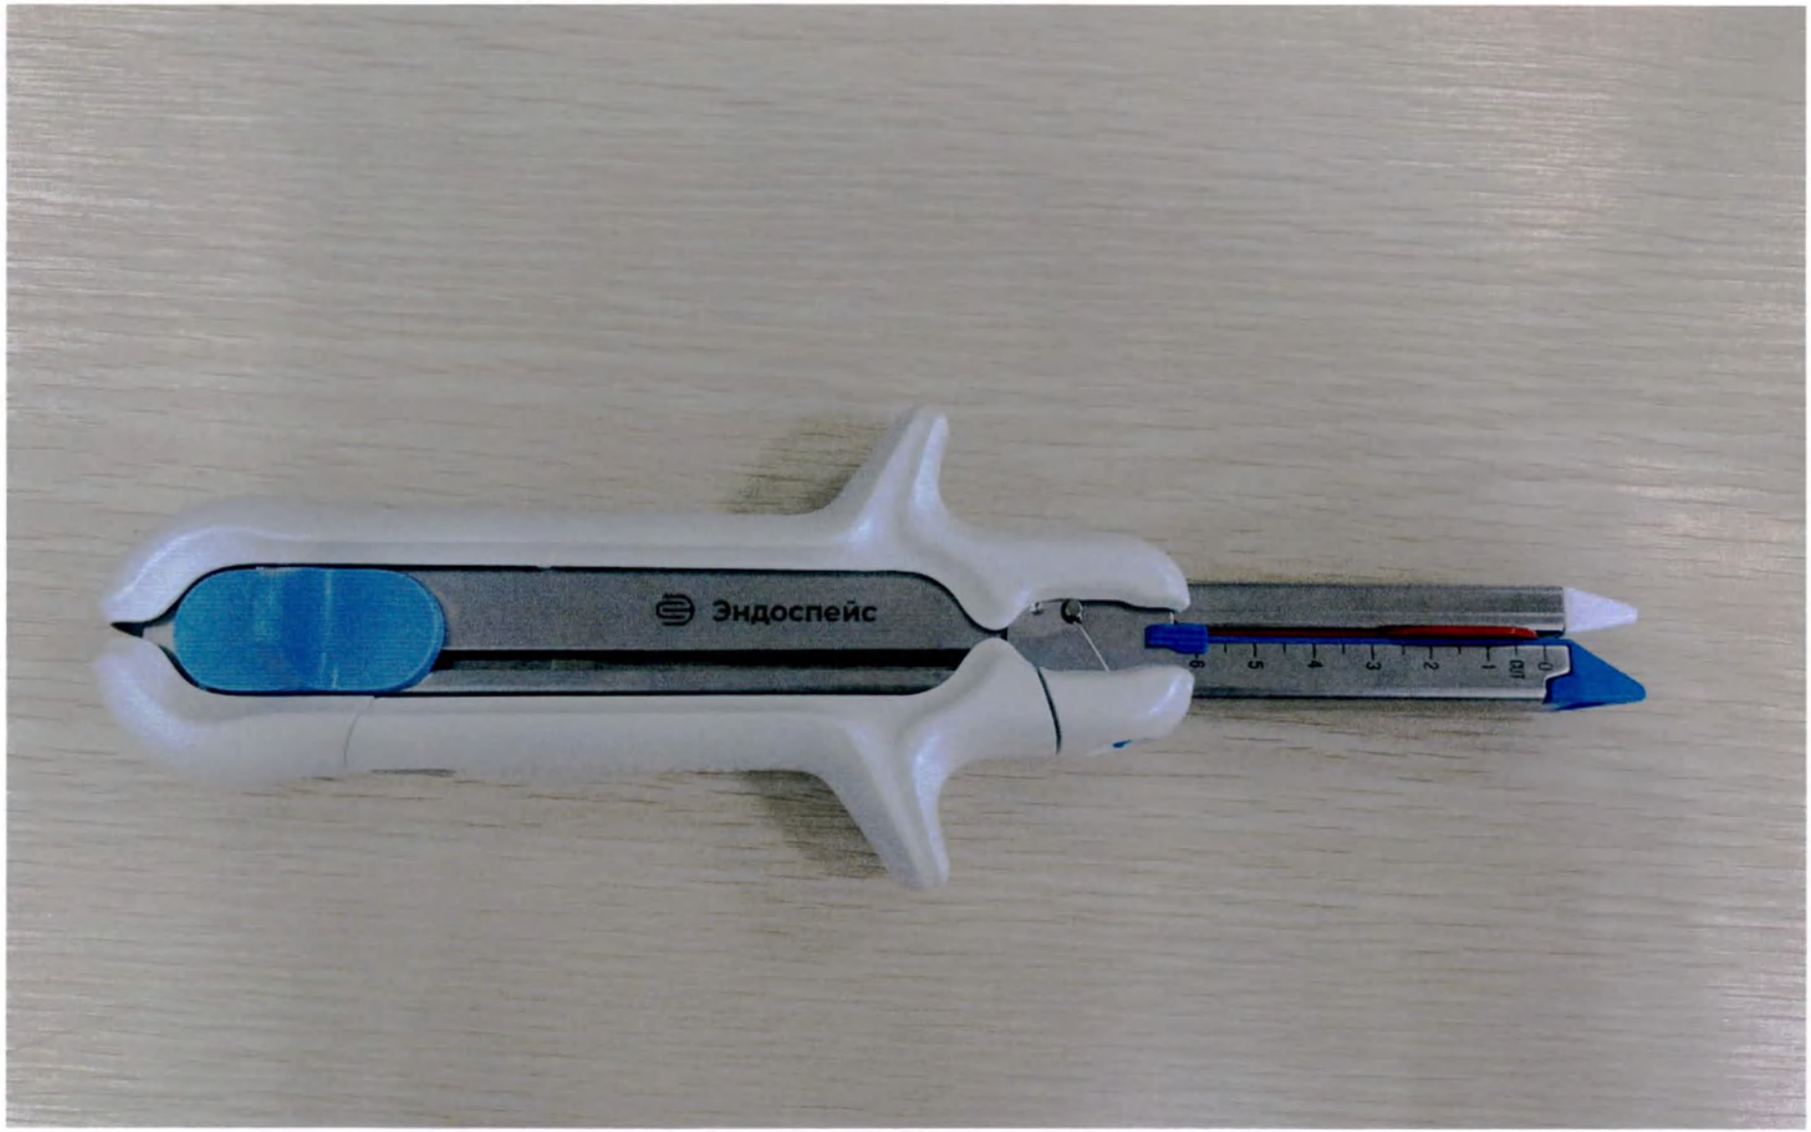

Рисунок 85 – Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 86 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно STERILE R Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

Рисунок 86А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

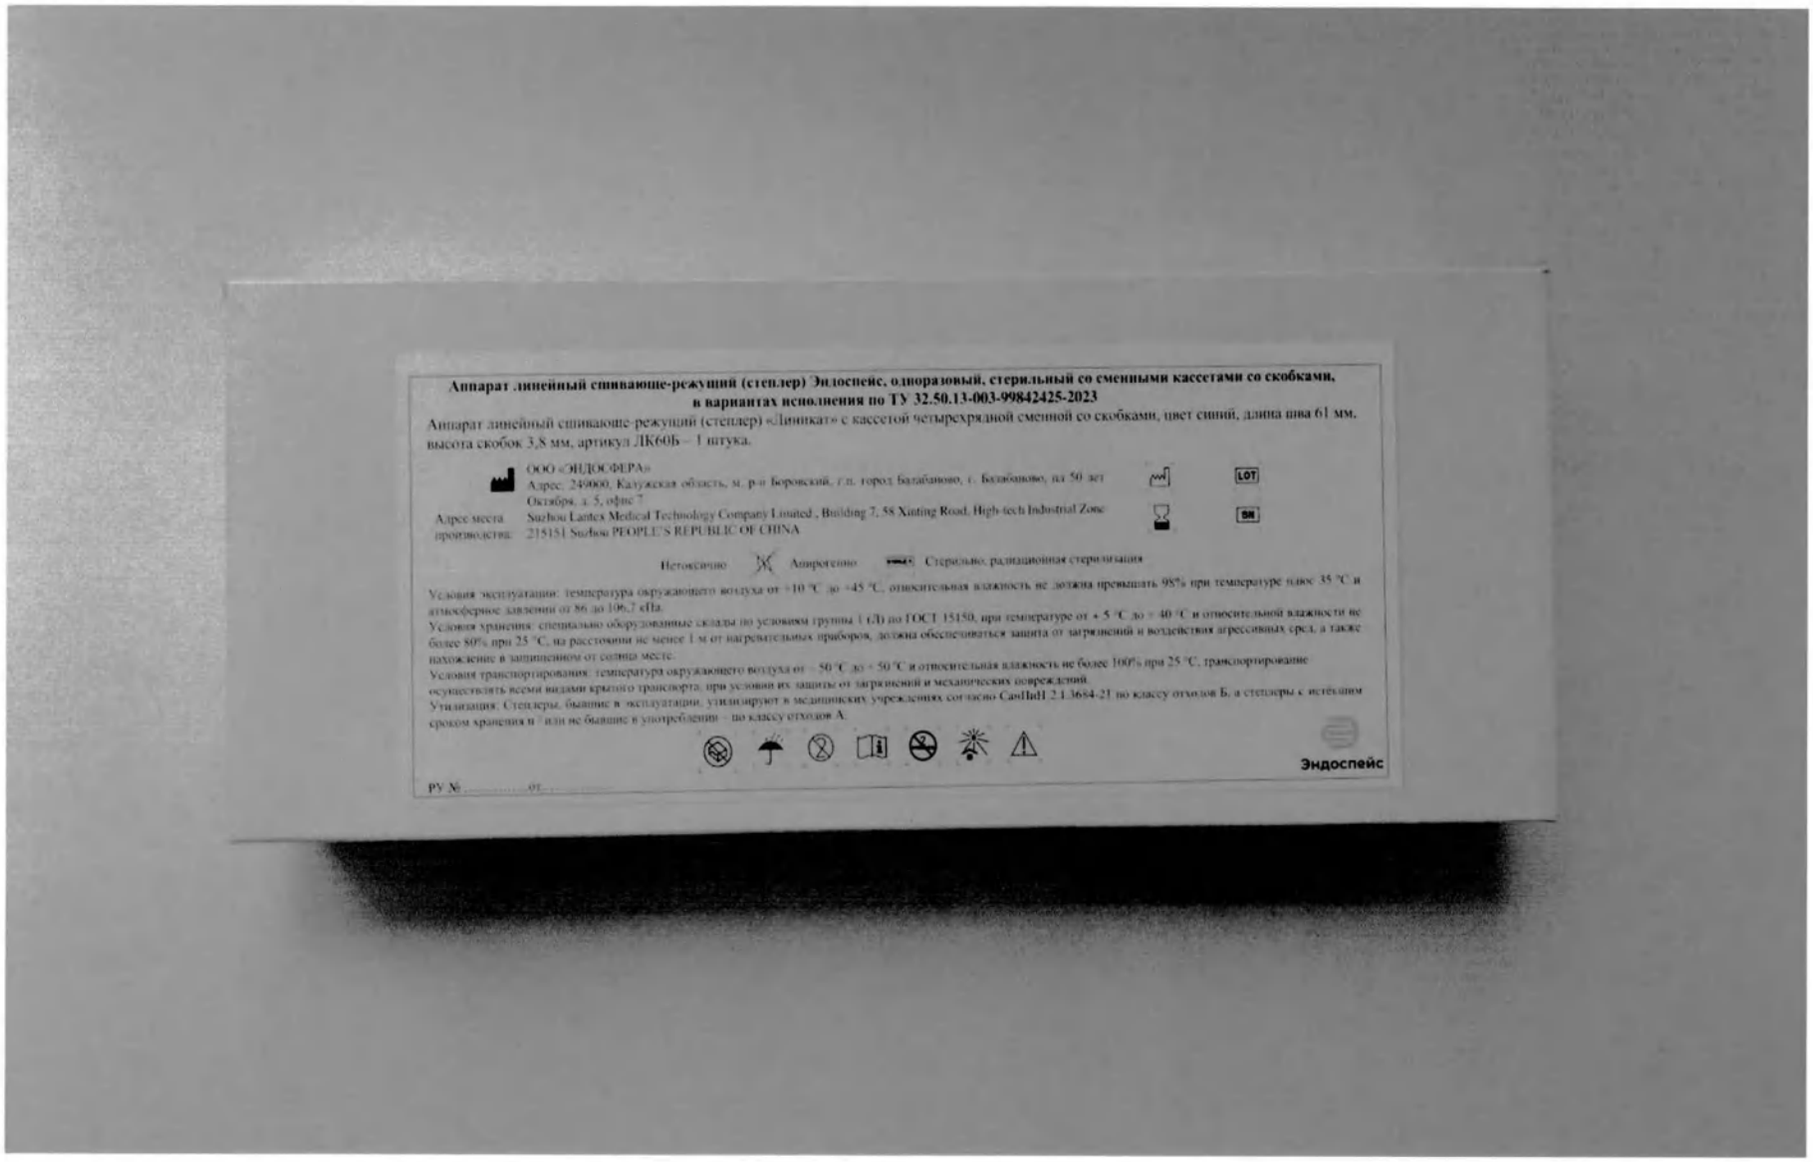

Рисунок 87 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно STERILE R Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 87А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

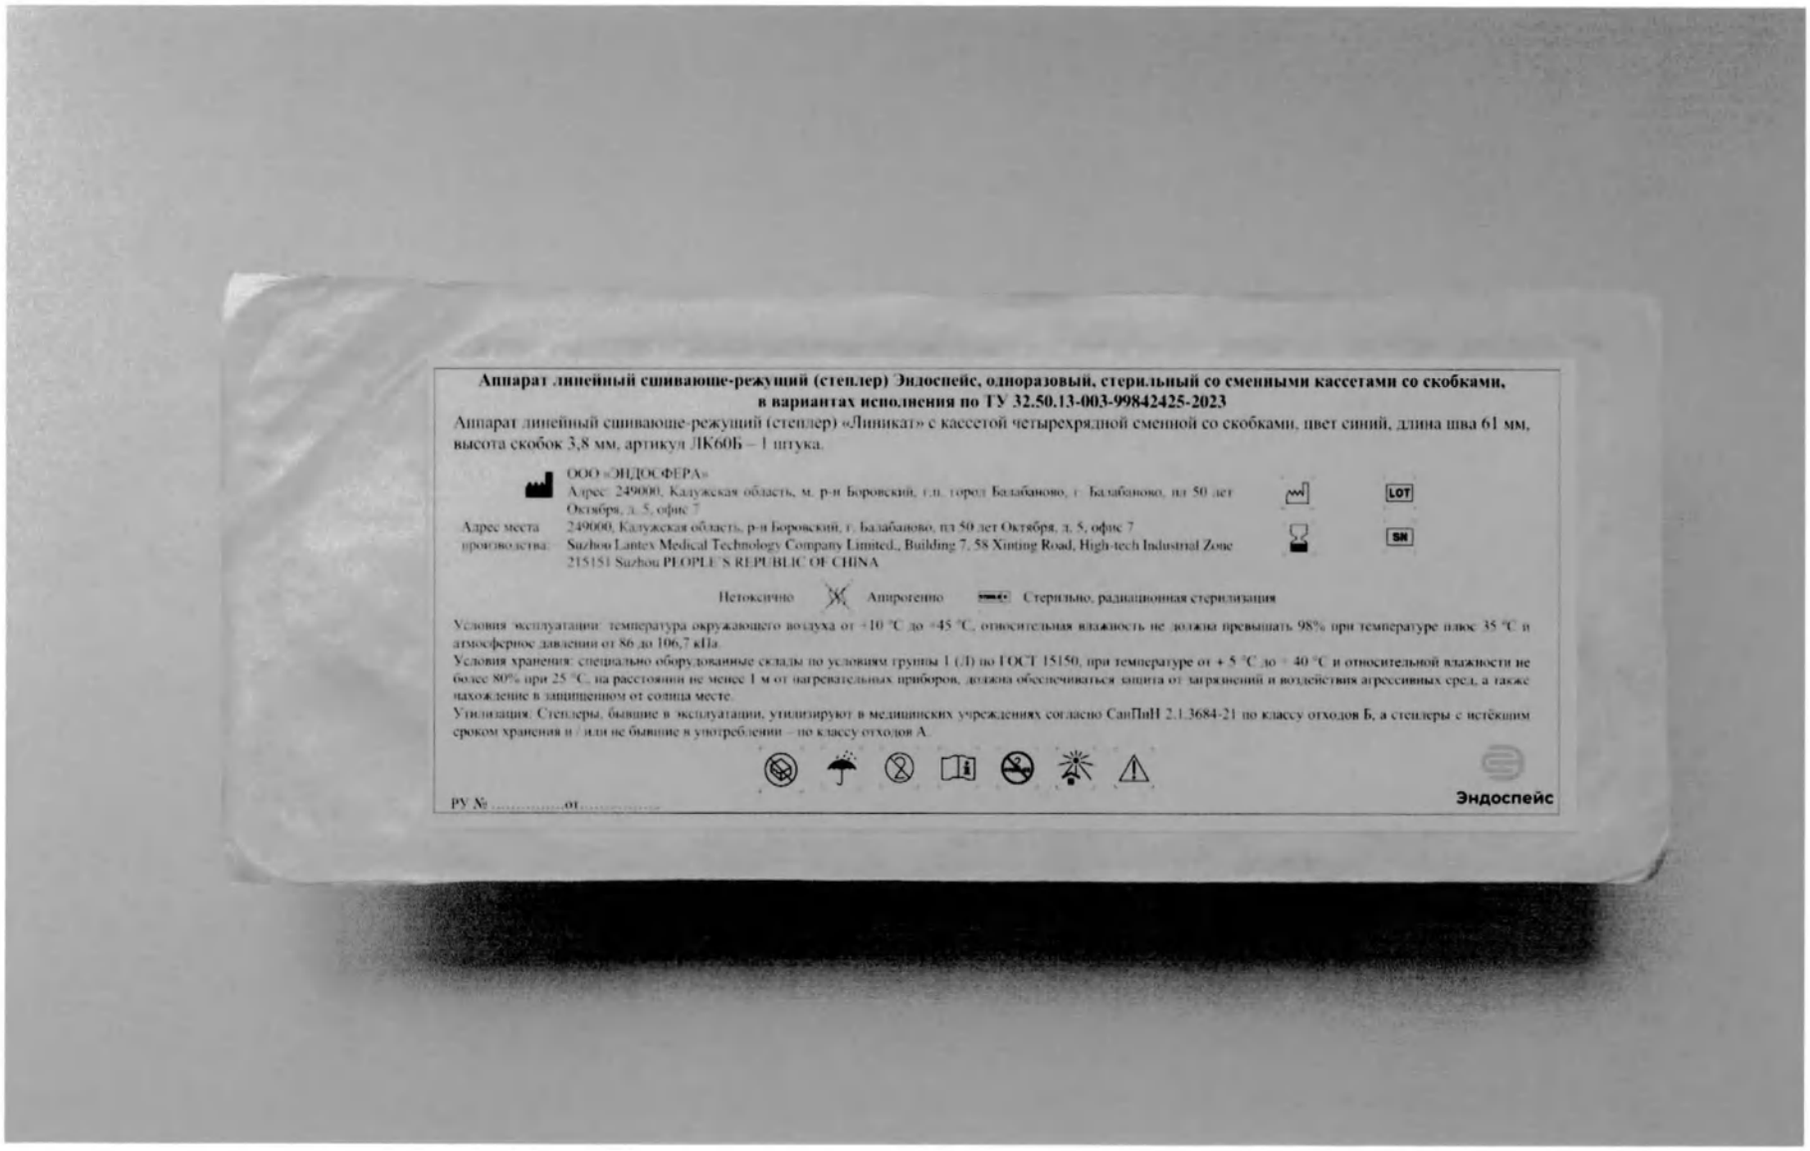

Рисунок 88 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

Рисунок 88А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

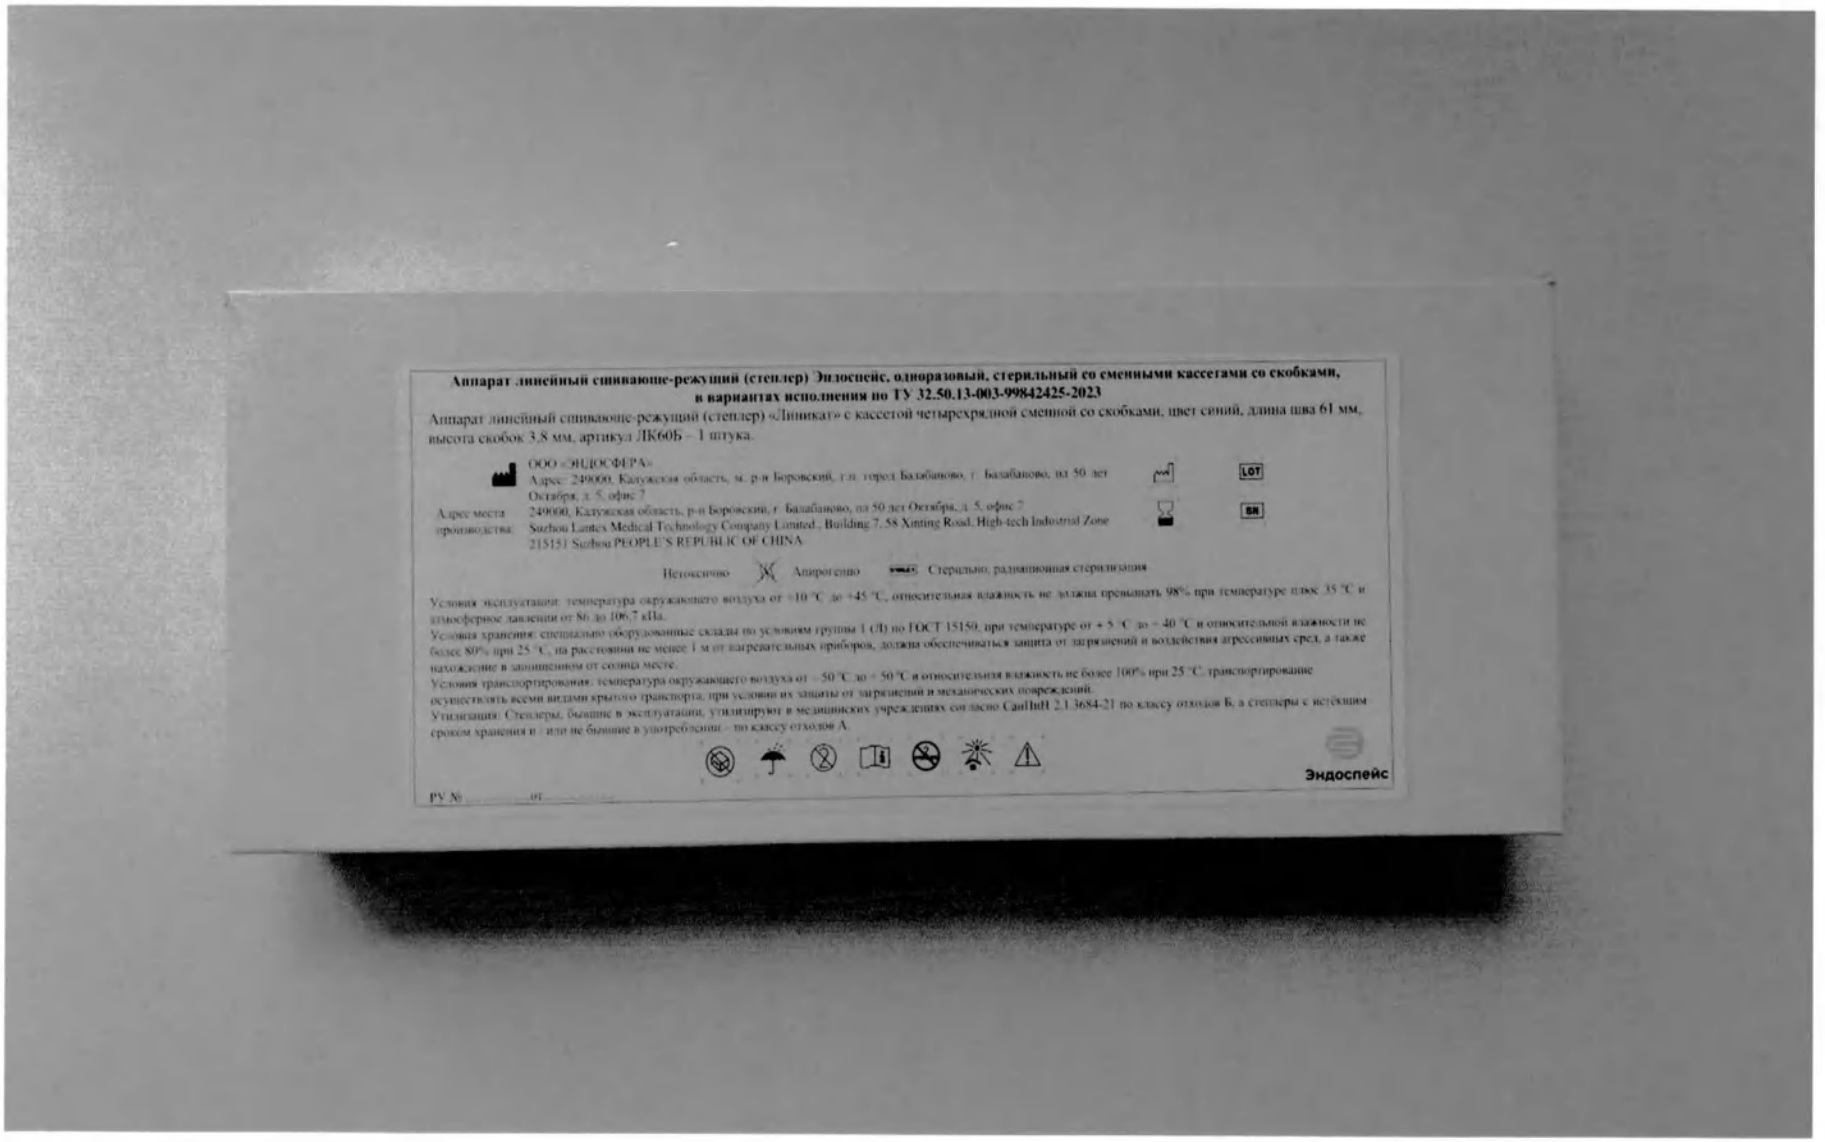

Рисунок 89 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 89А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 90 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

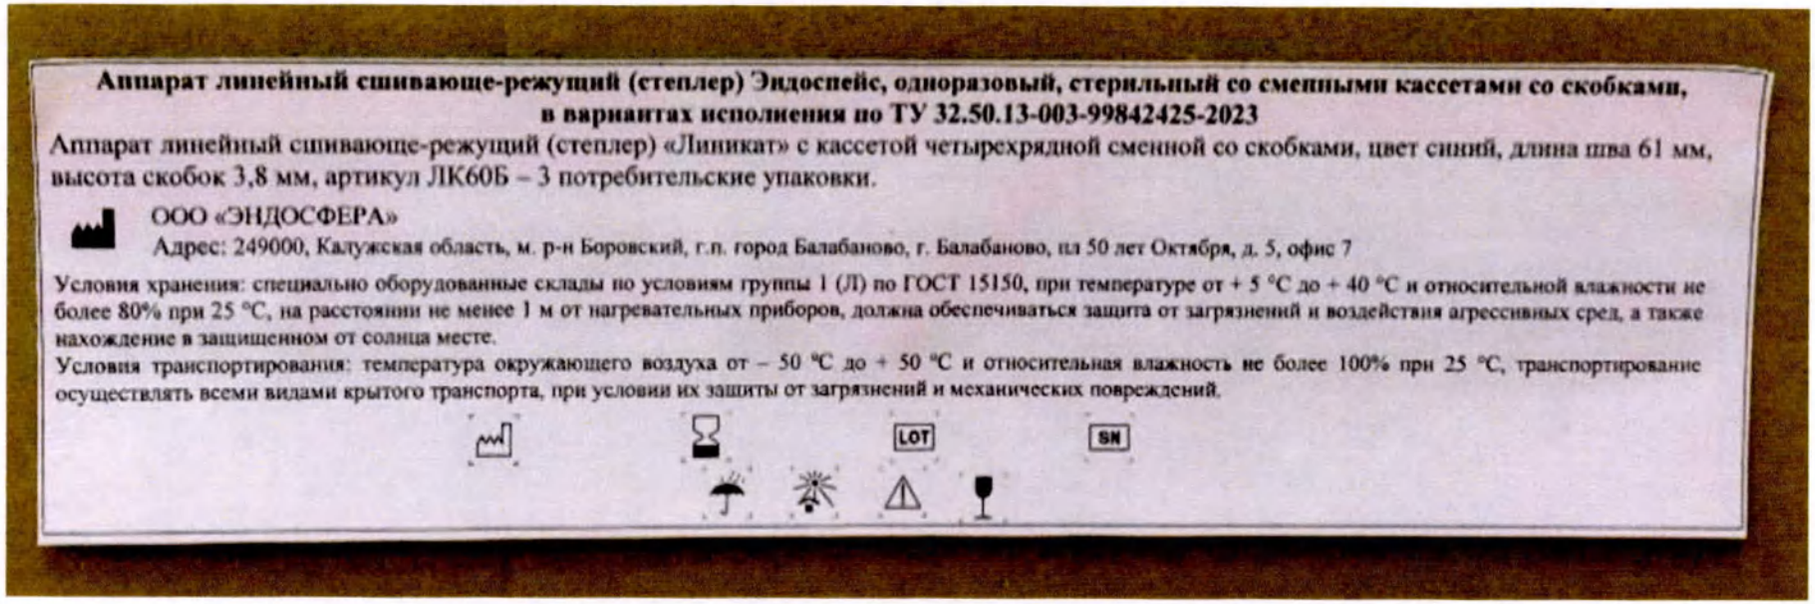

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 90А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

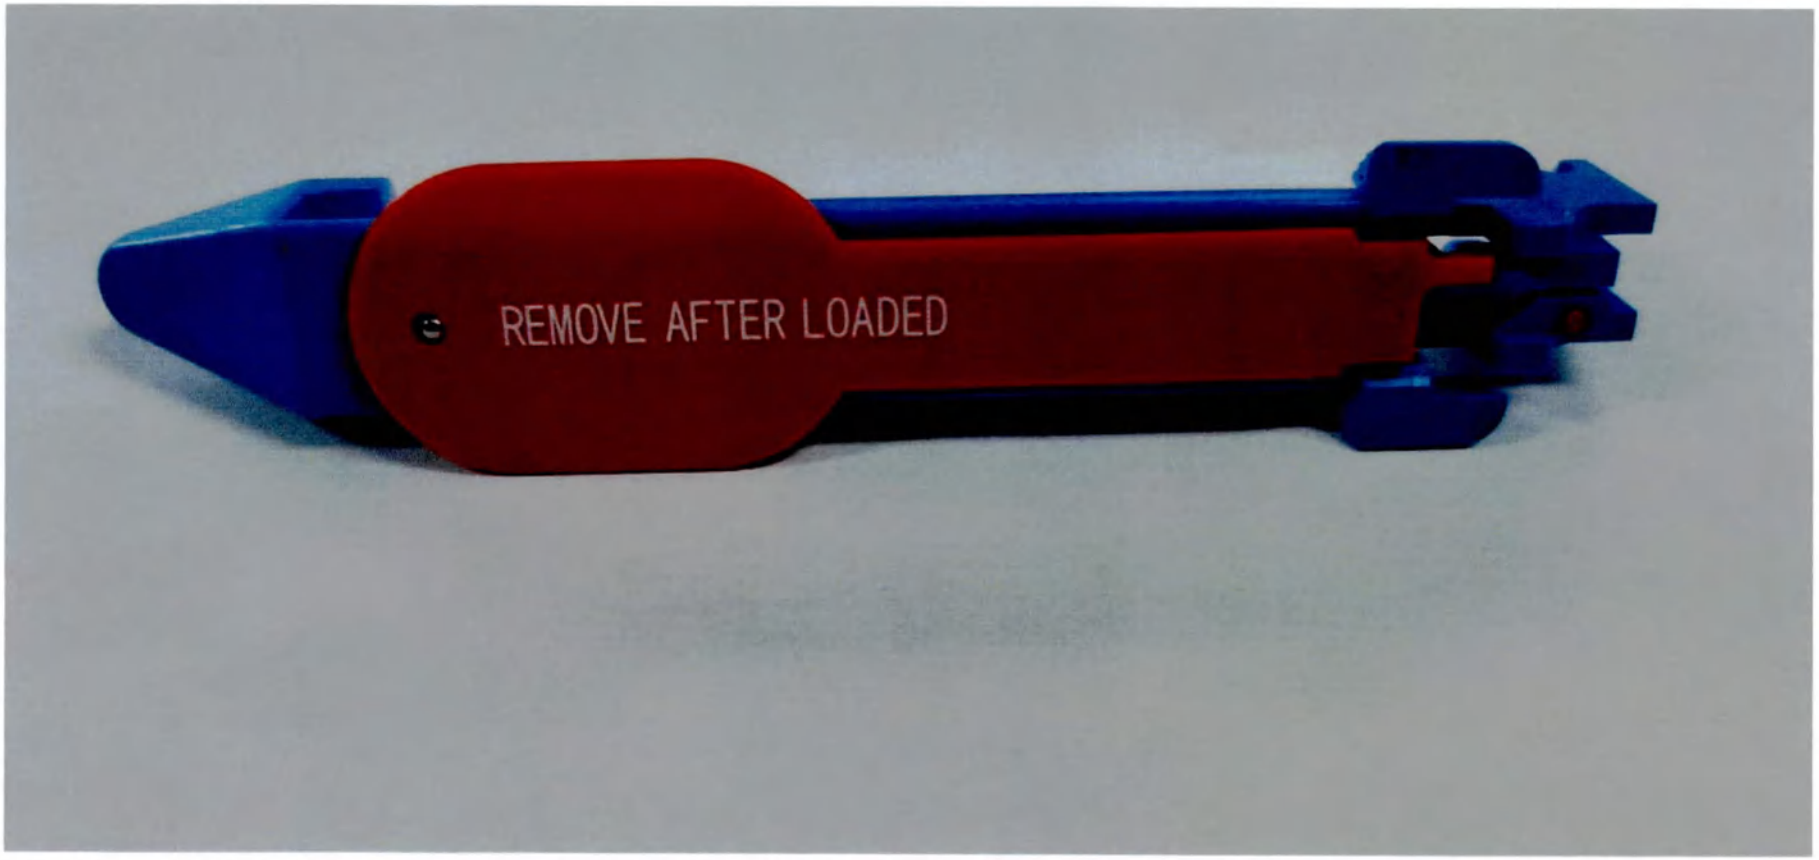

Рисунок 91 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 92 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

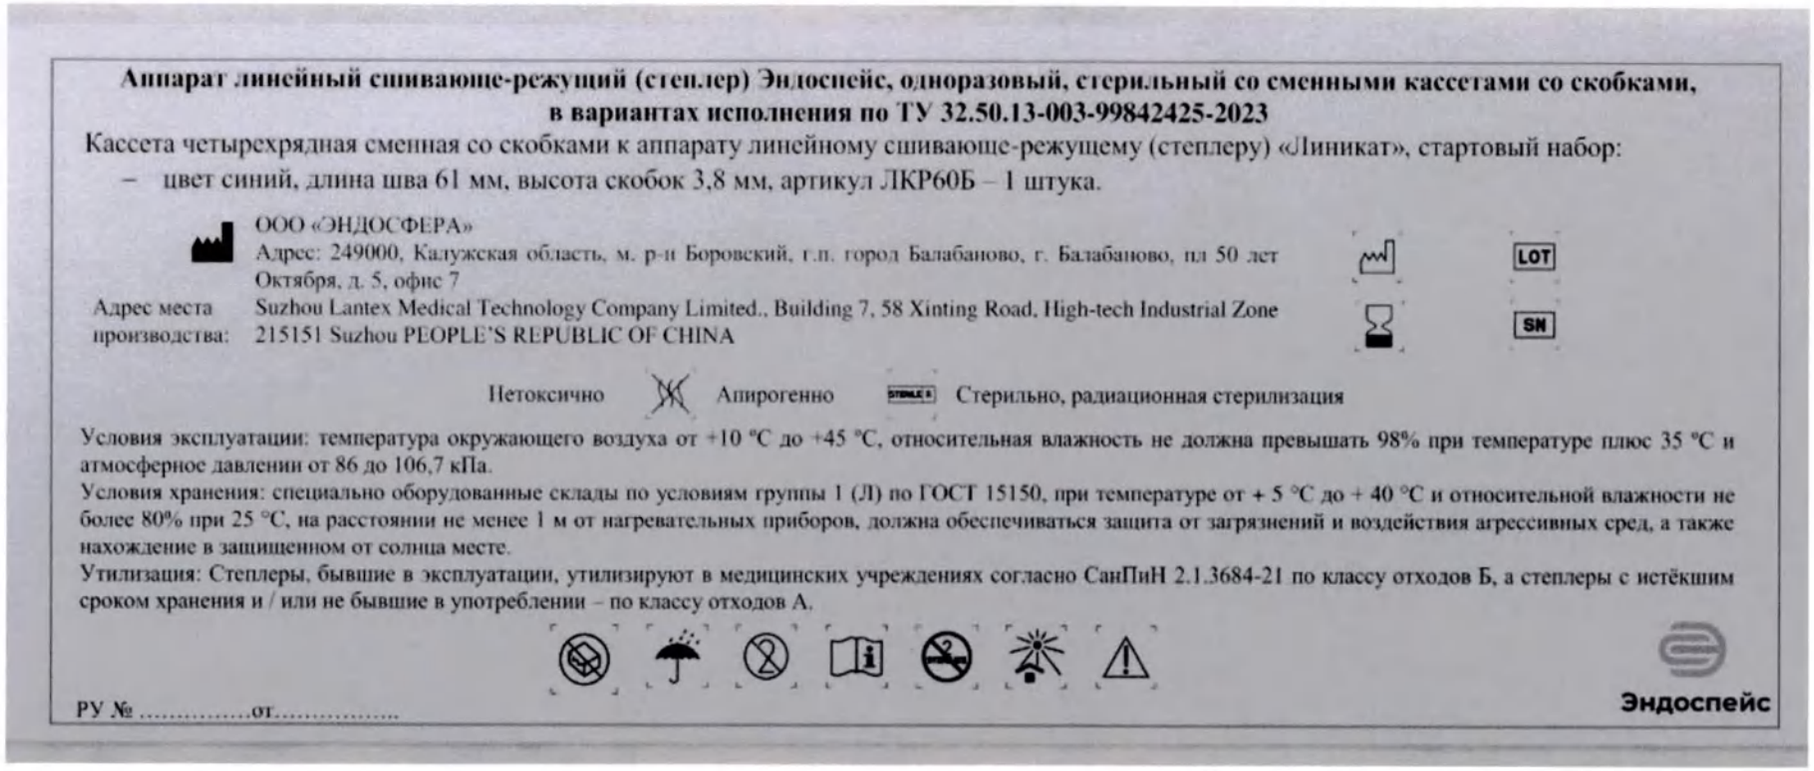

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 92А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

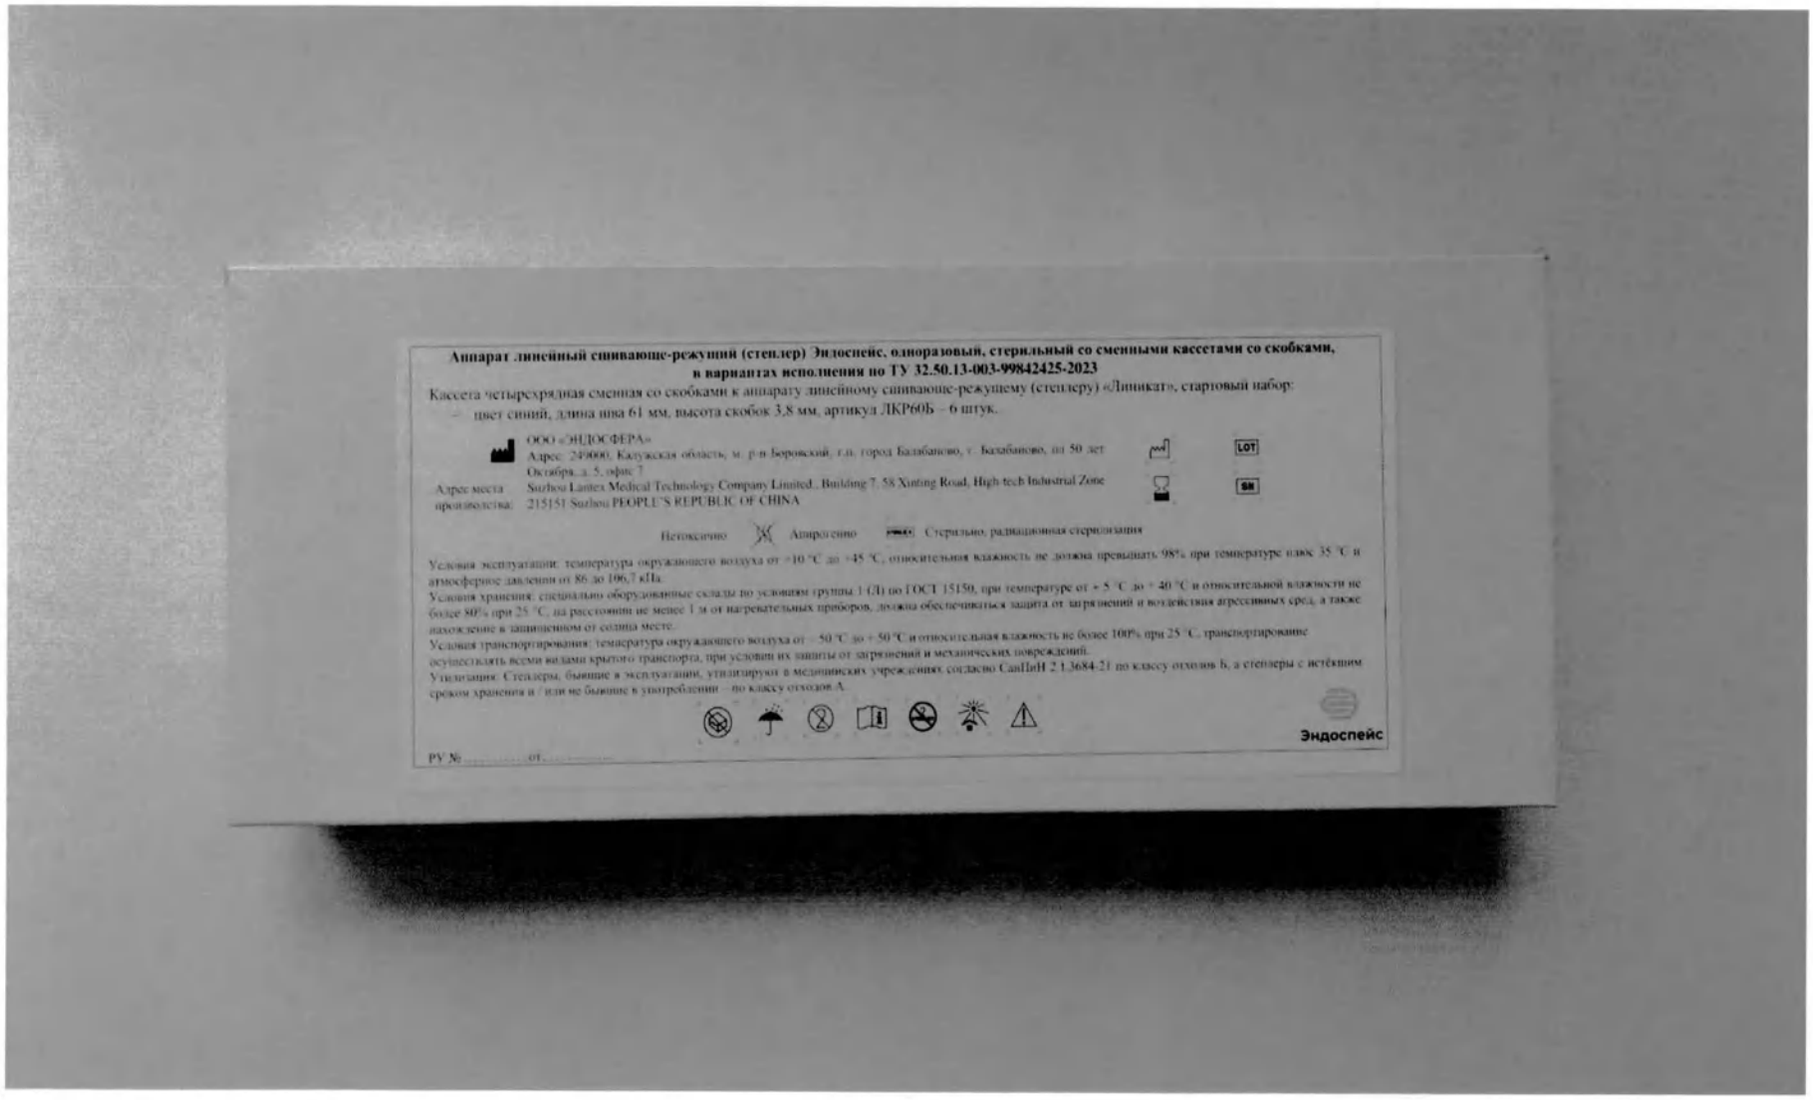

Рисунок 93 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

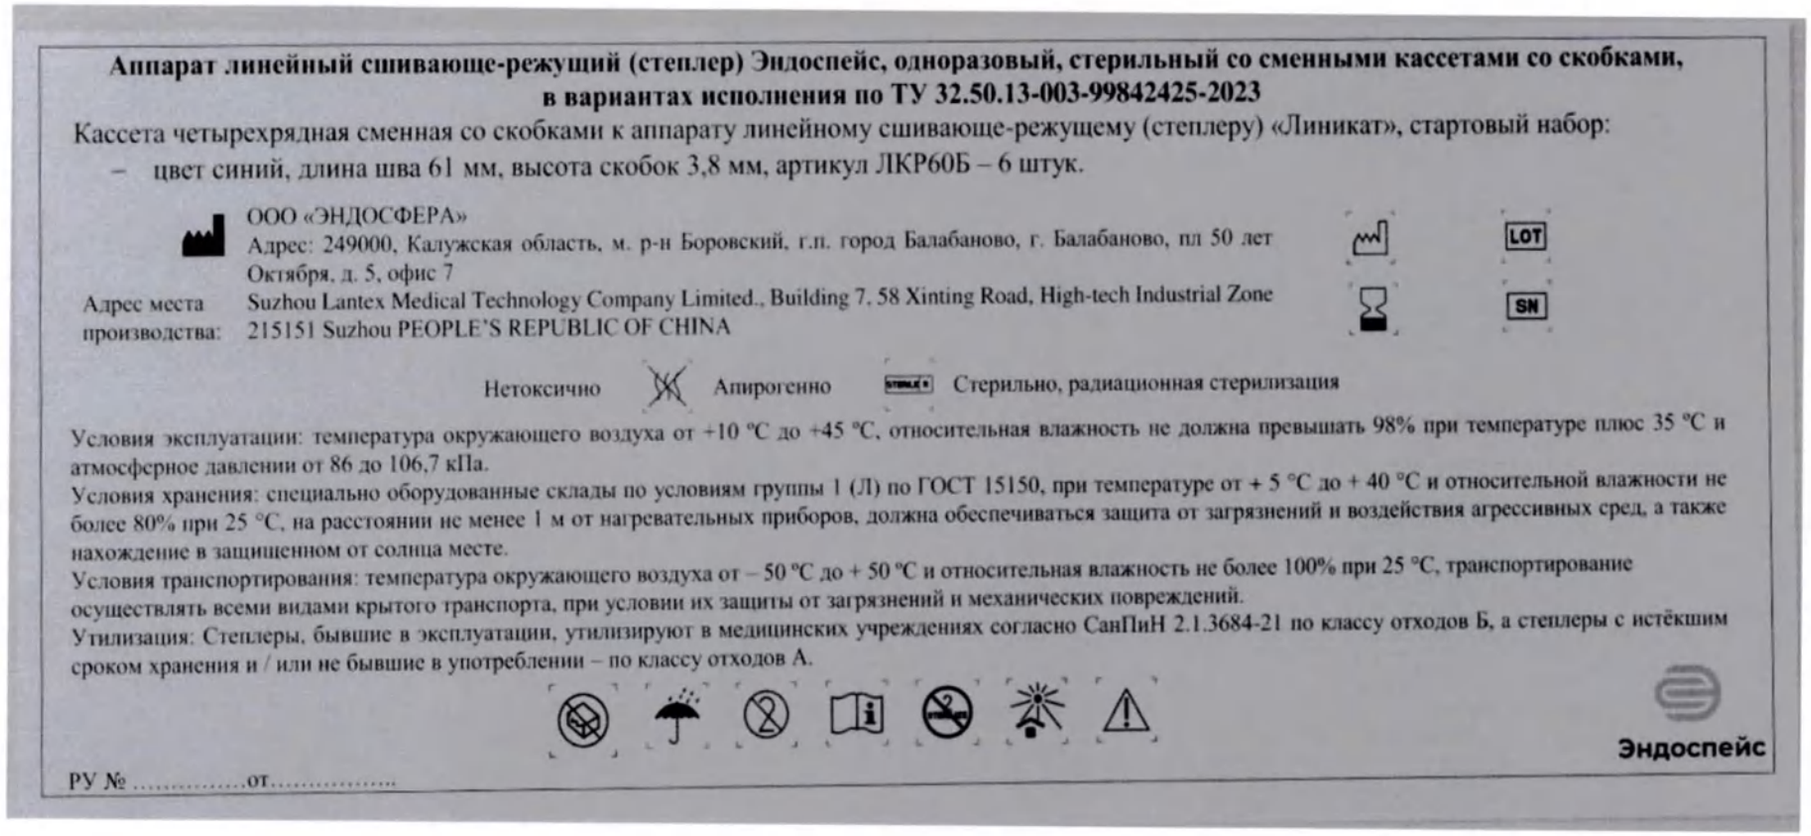

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 93А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 94 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

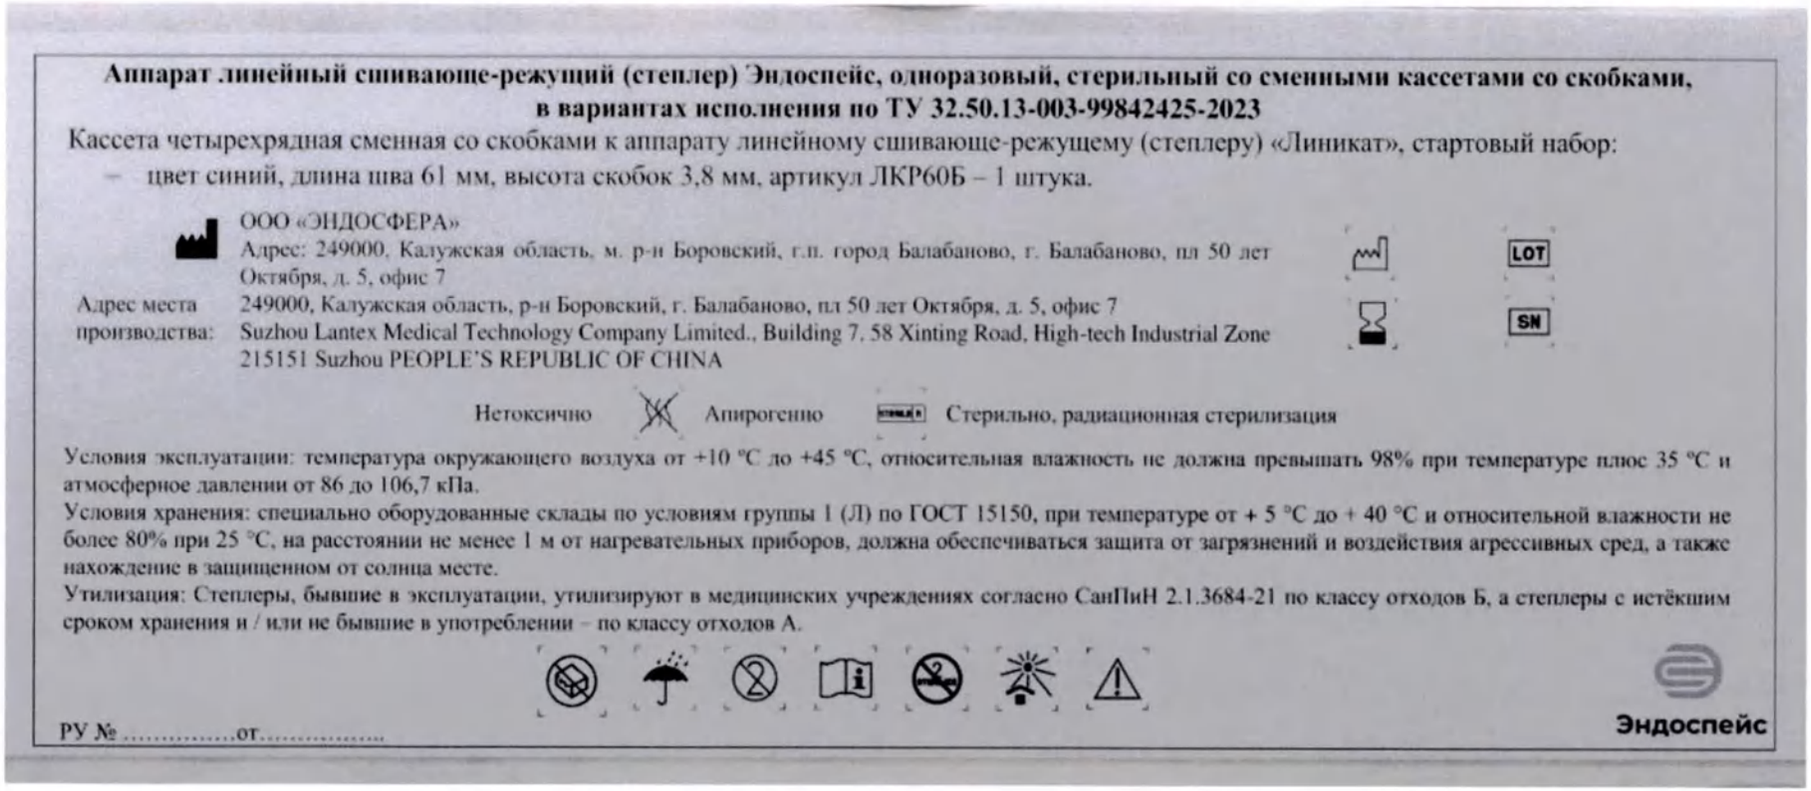

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 94А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

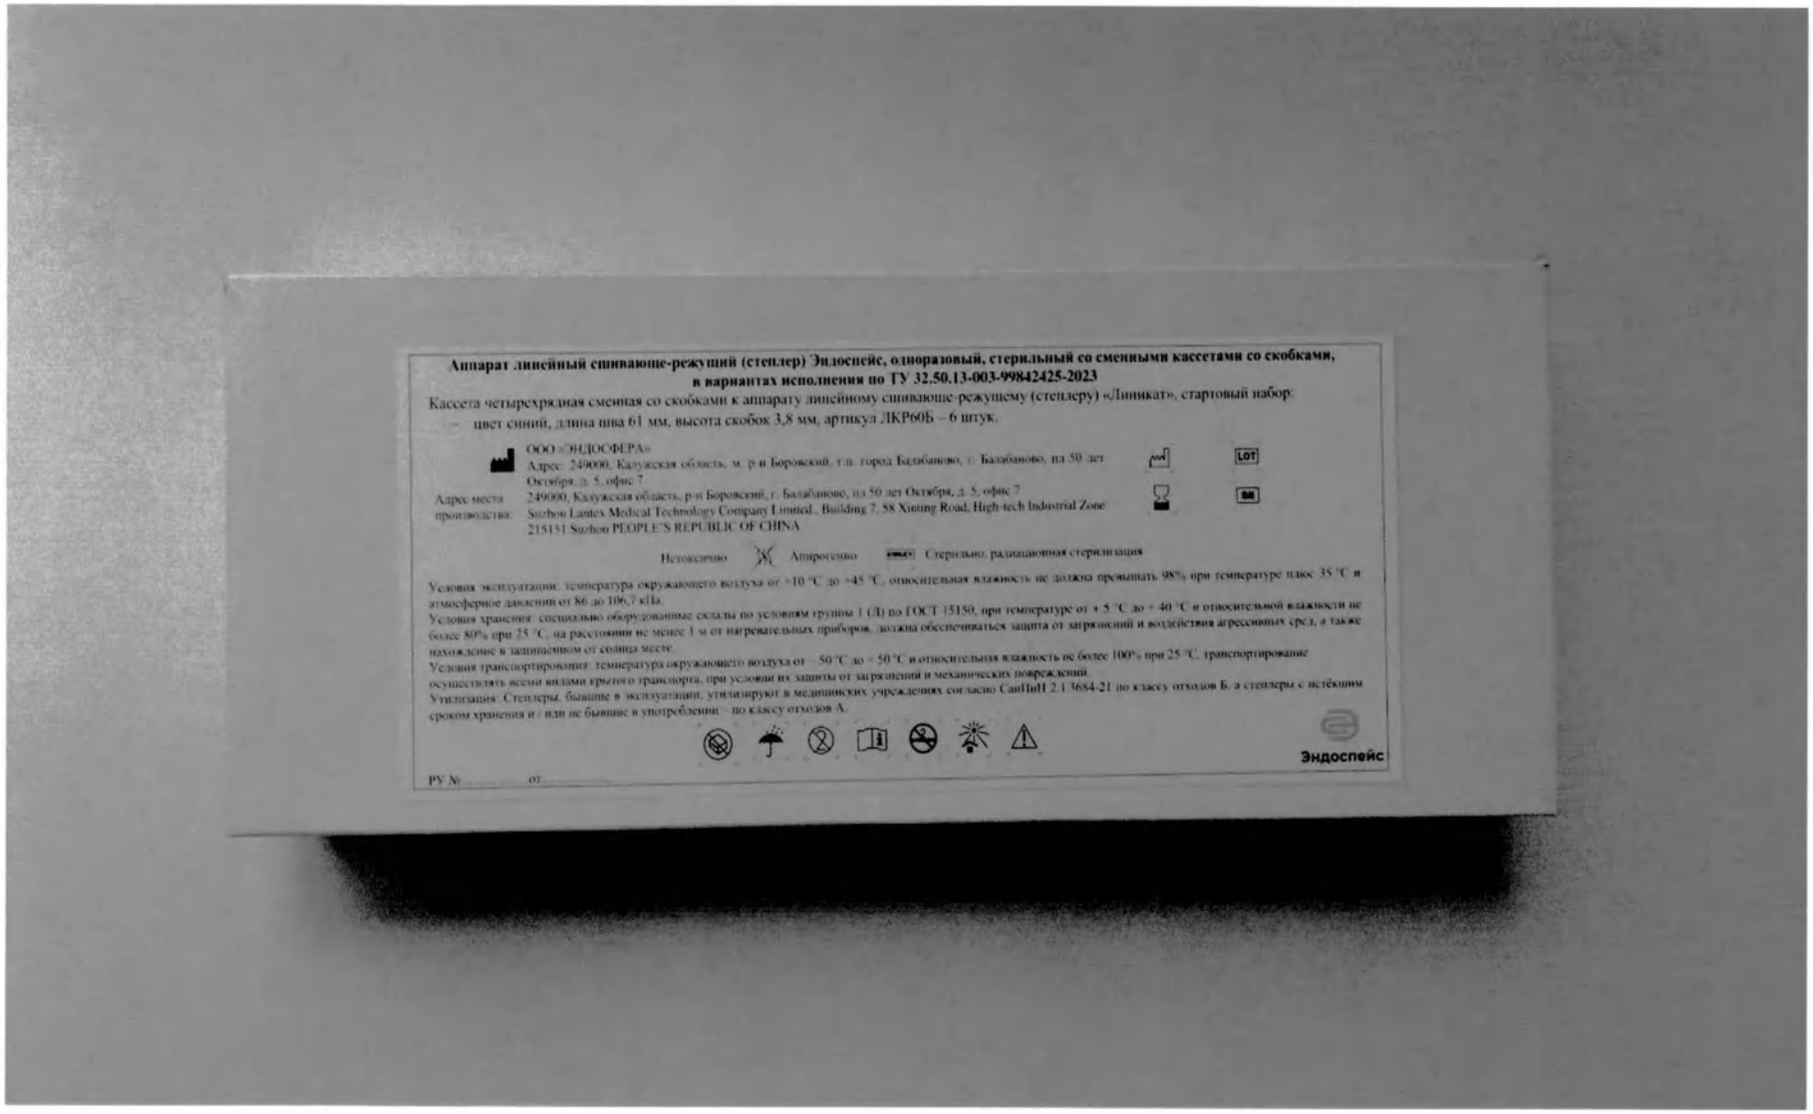

Рисунок 95 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

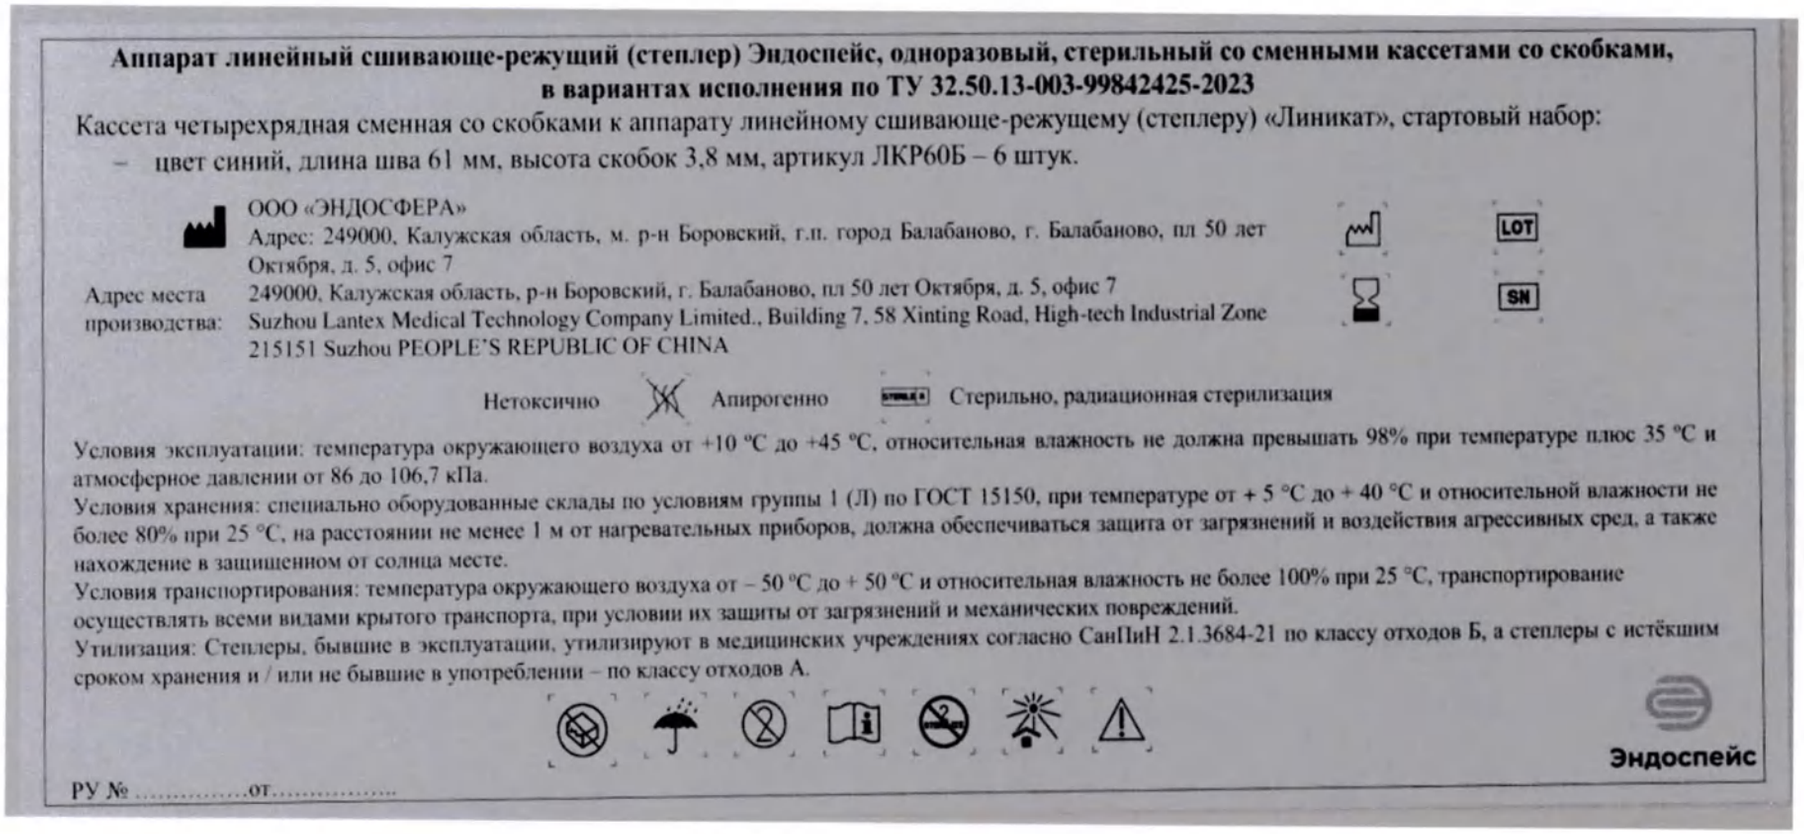

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 95А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 96 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

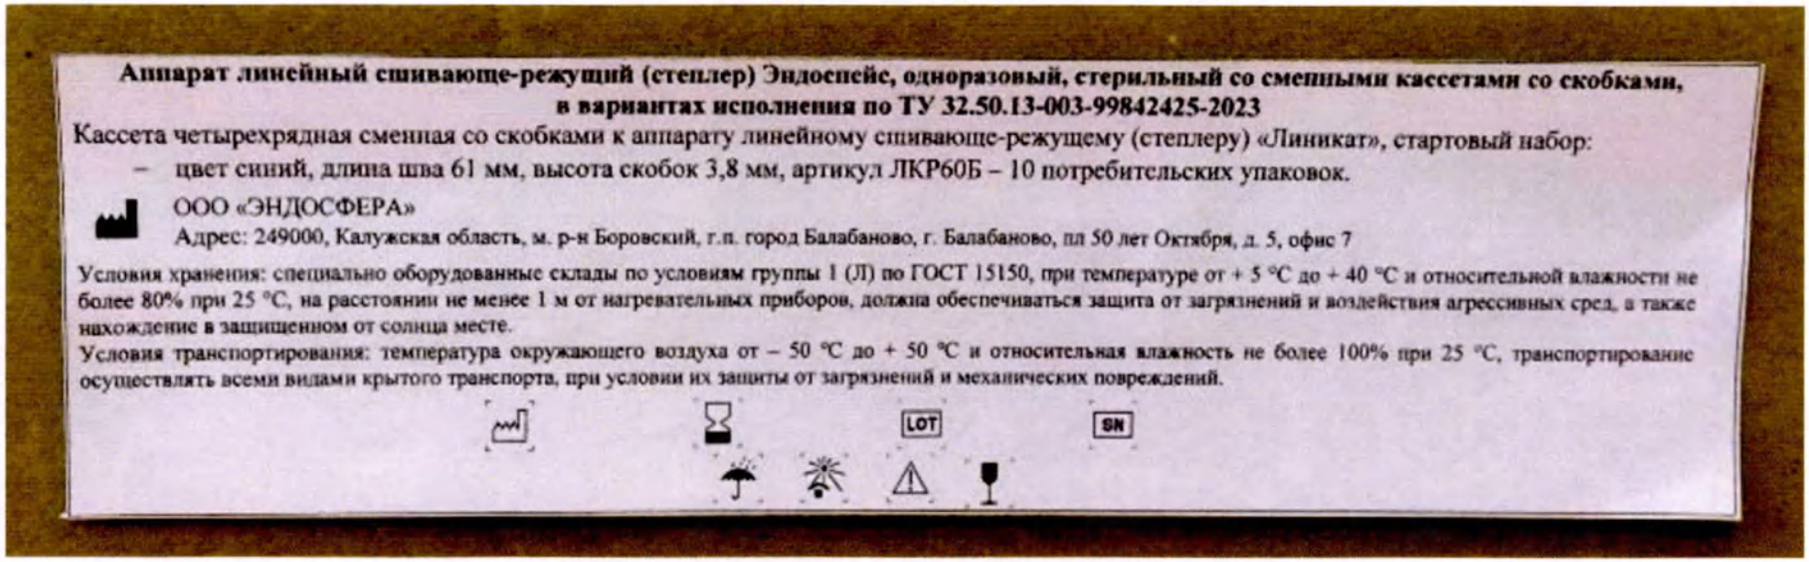

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 96А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 61 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

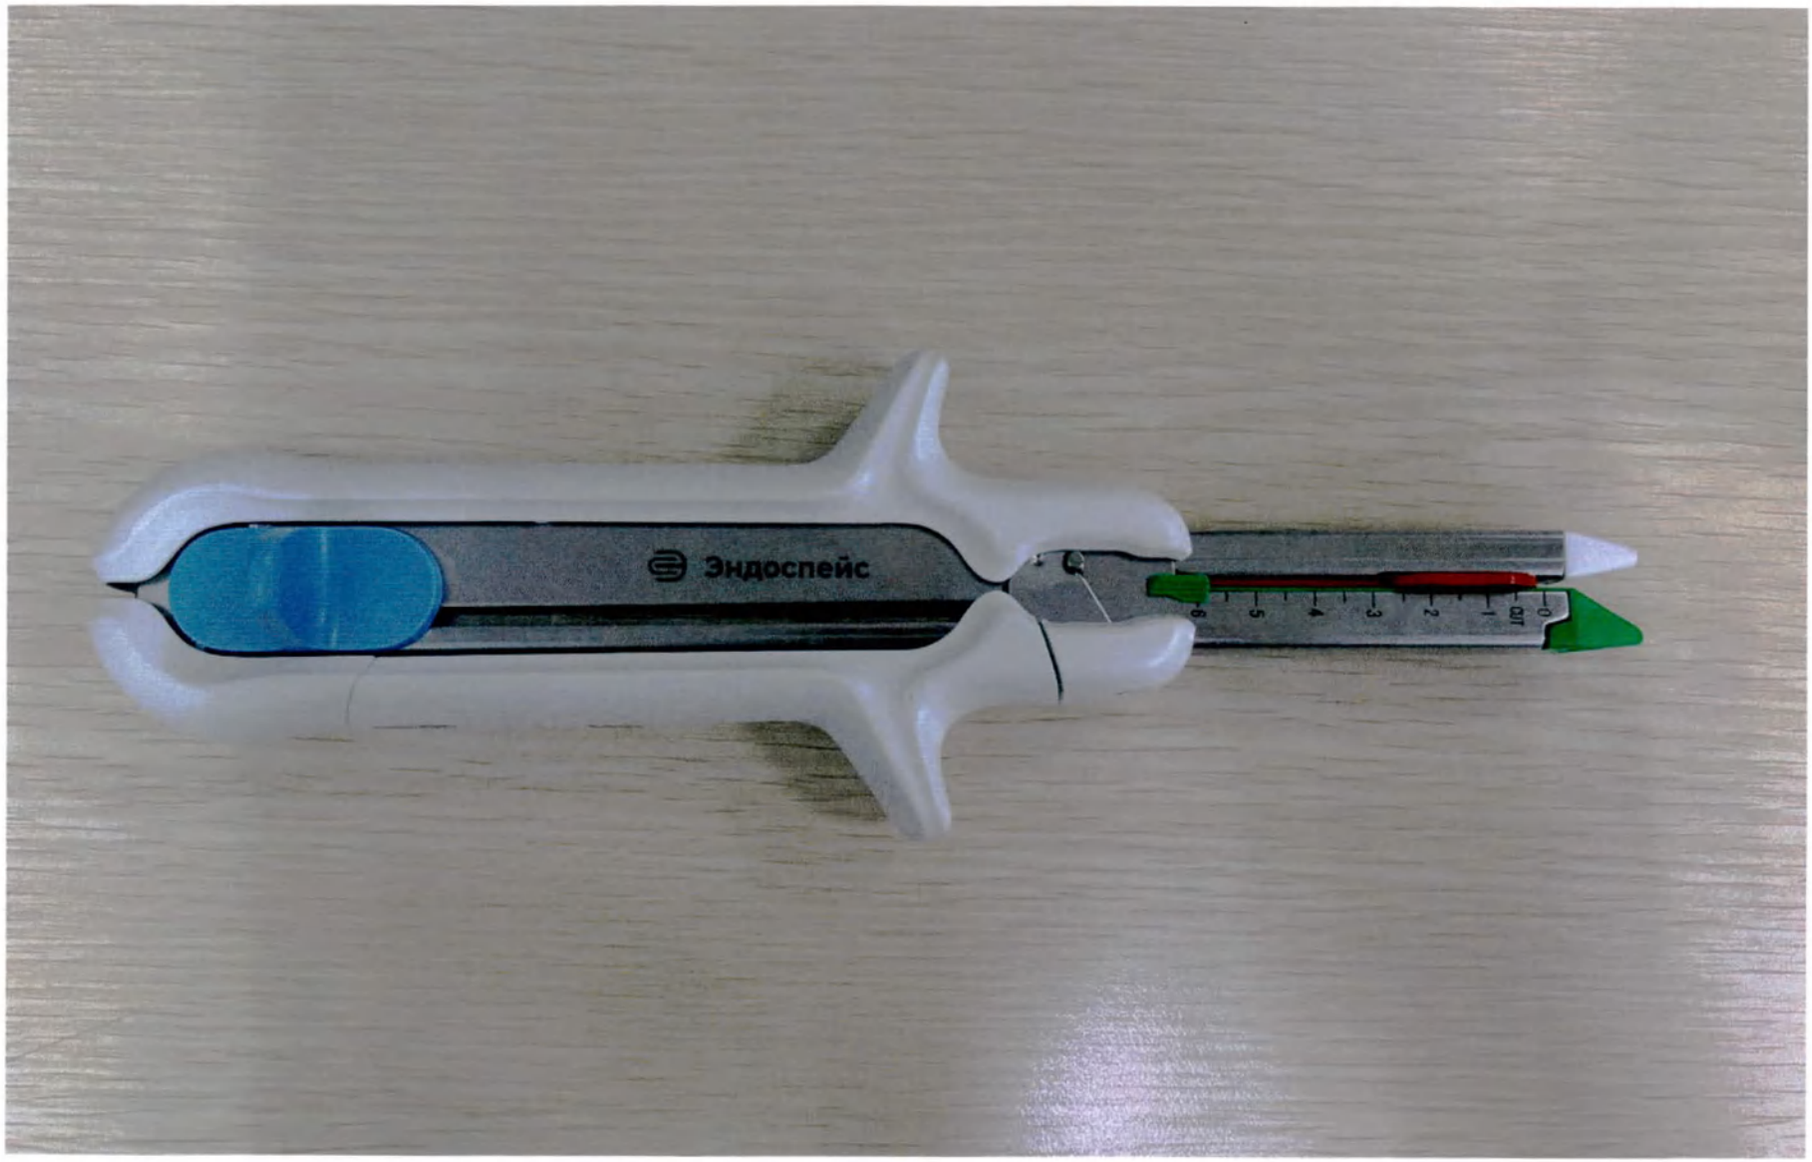

Рисунок 97 – Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 98 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 98А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

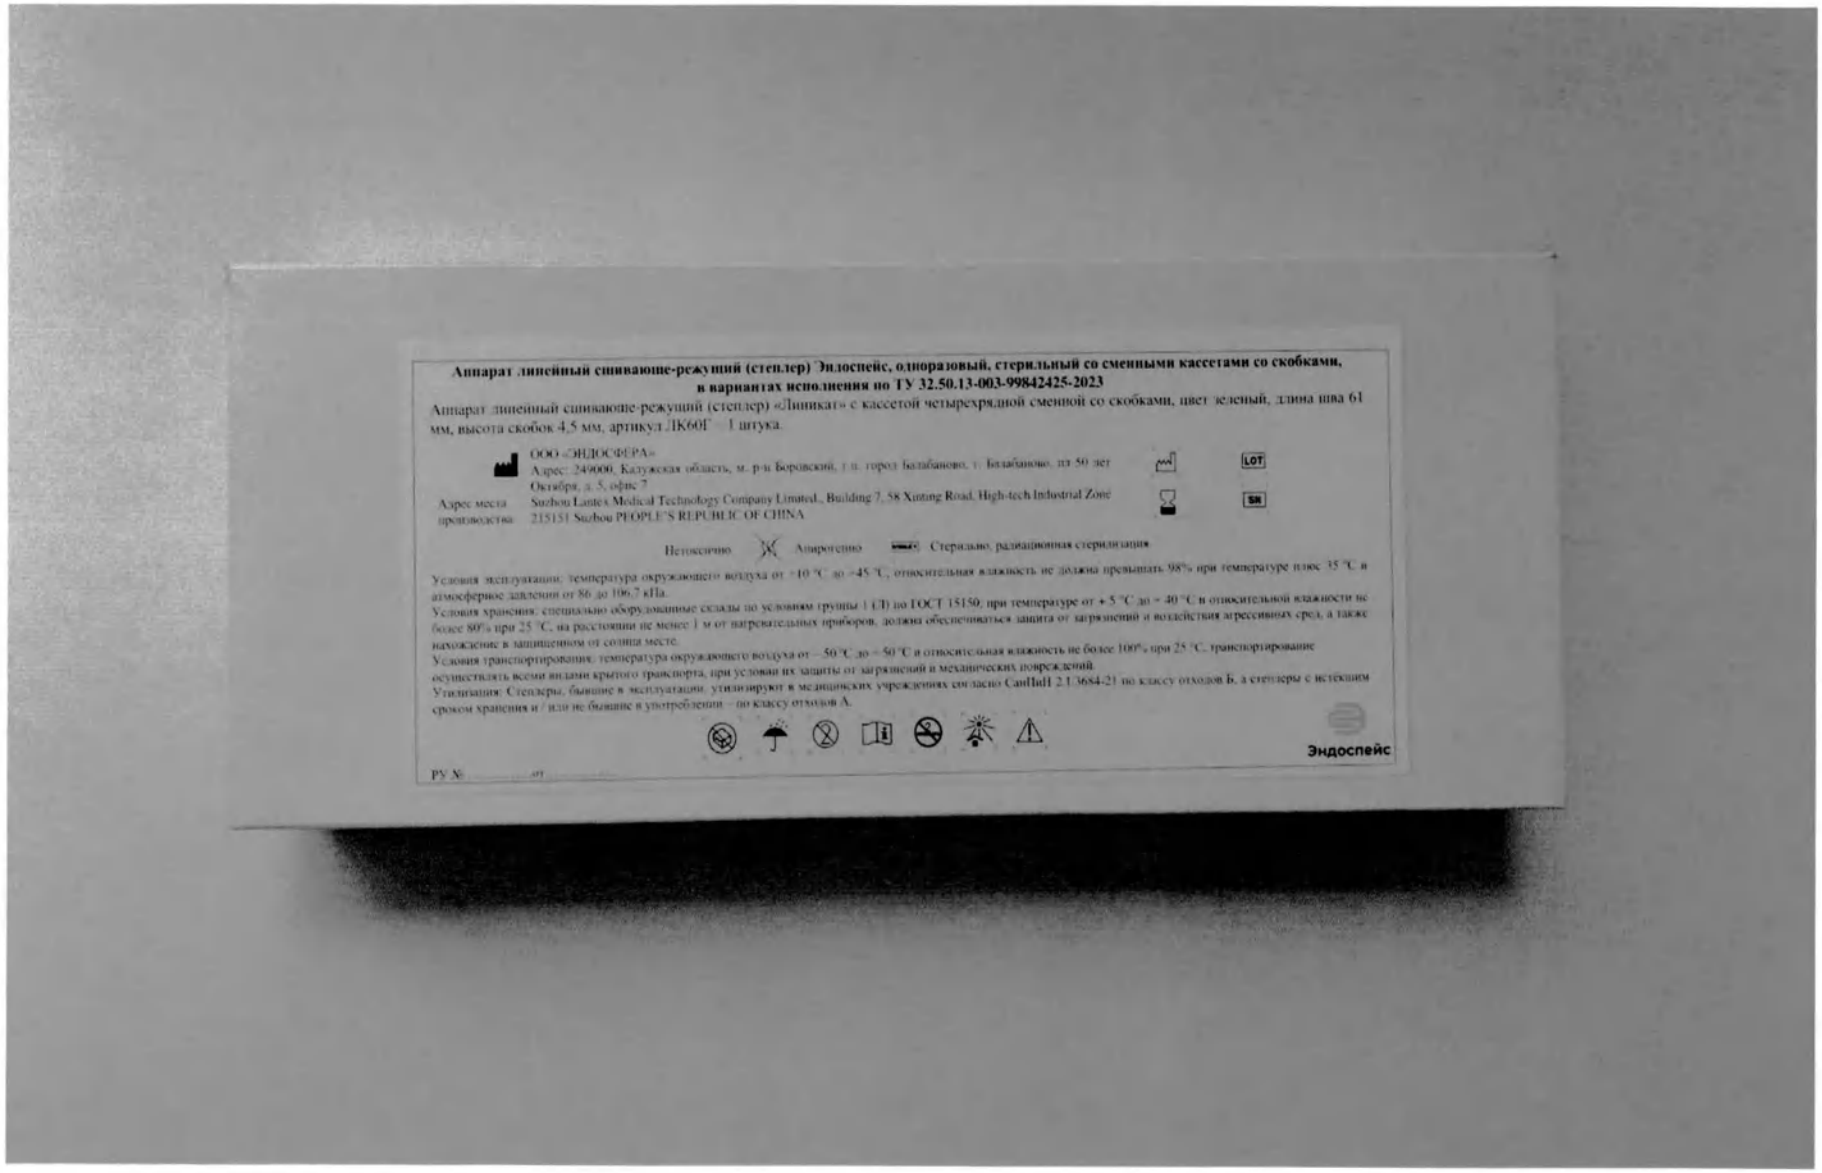

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, ул 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150; при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ №: ..... от .....

Рисунок 99 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 99А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

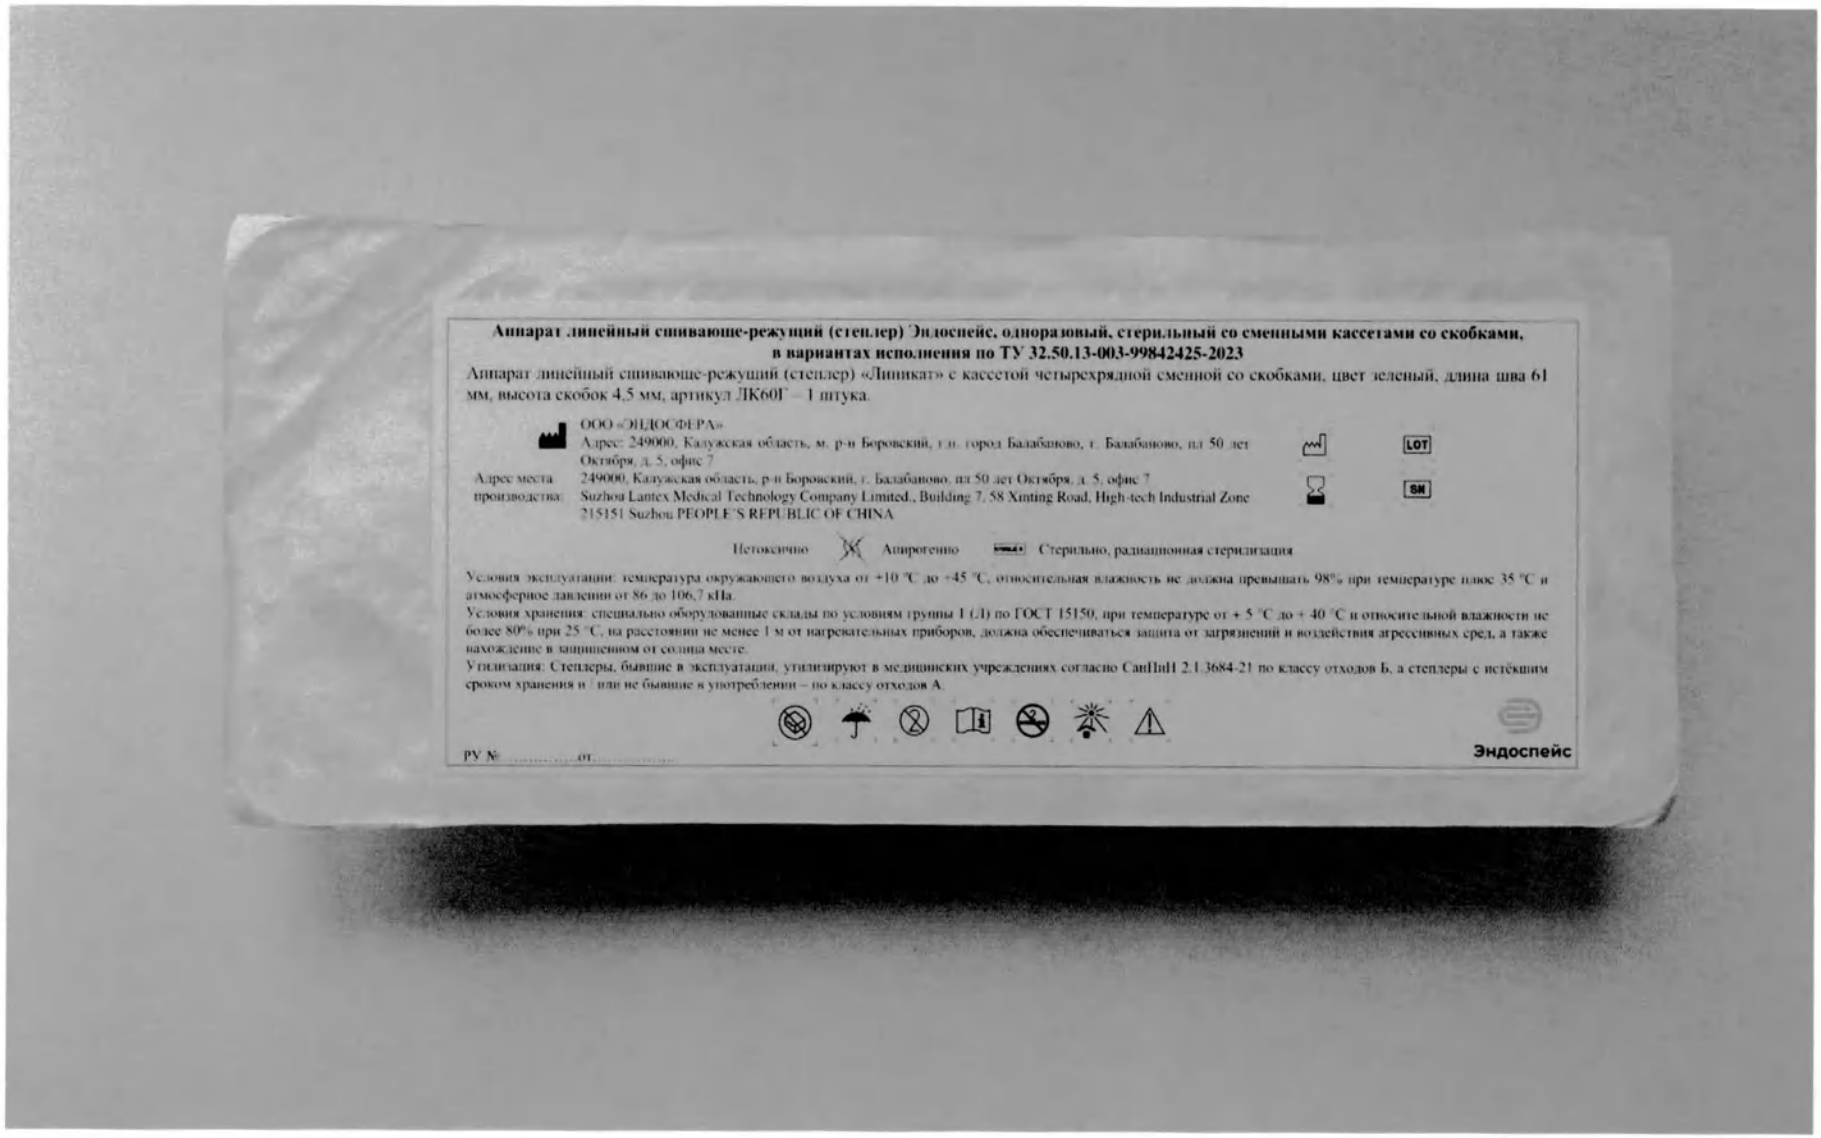

Рисунок 100 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 100А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

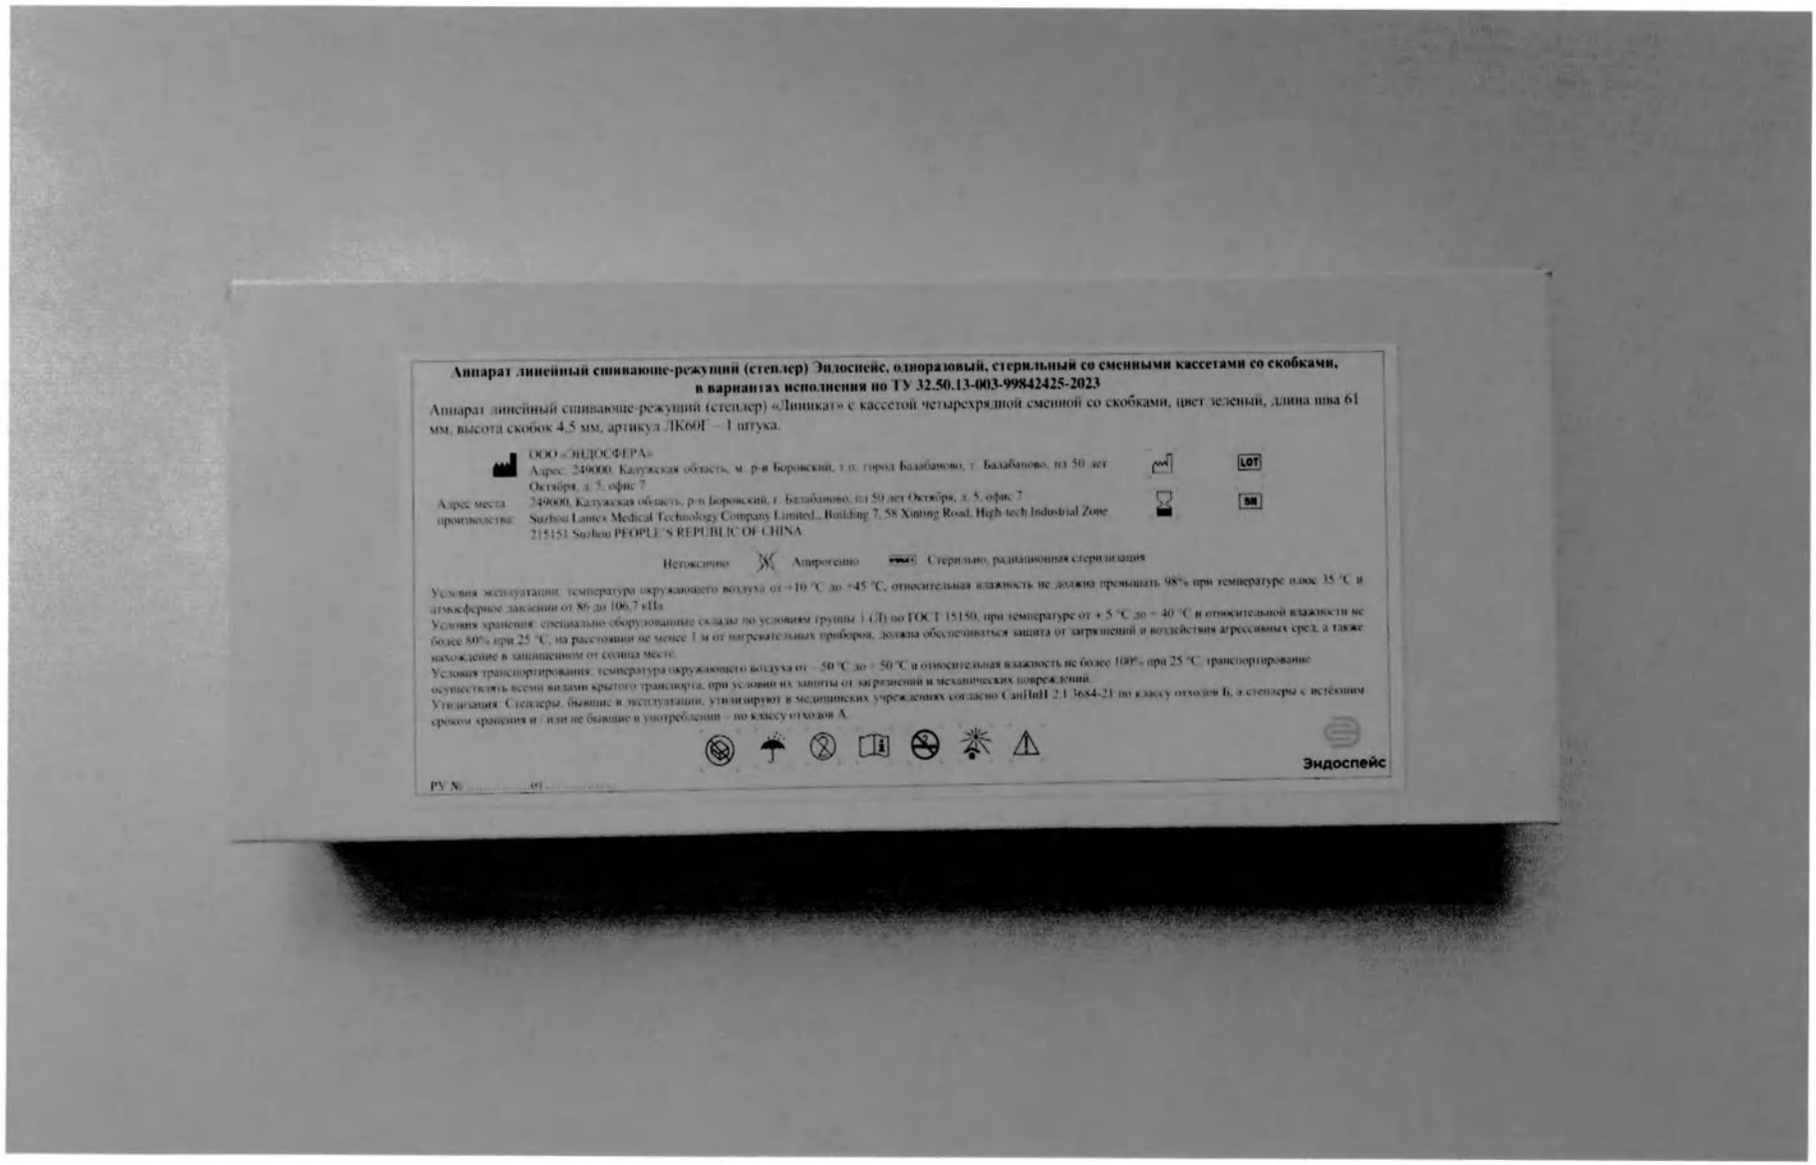

Рисунок 101 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 101А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 102 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

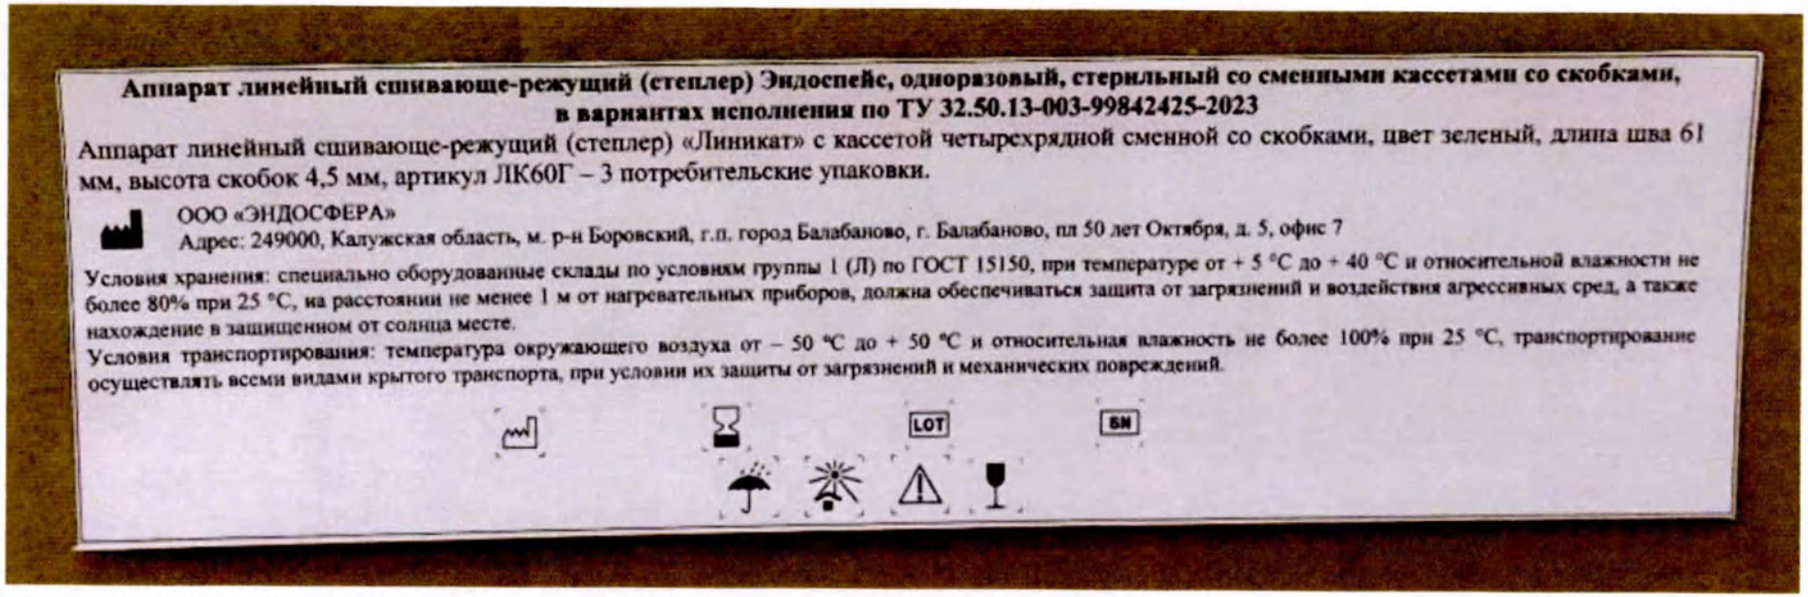

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 102А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

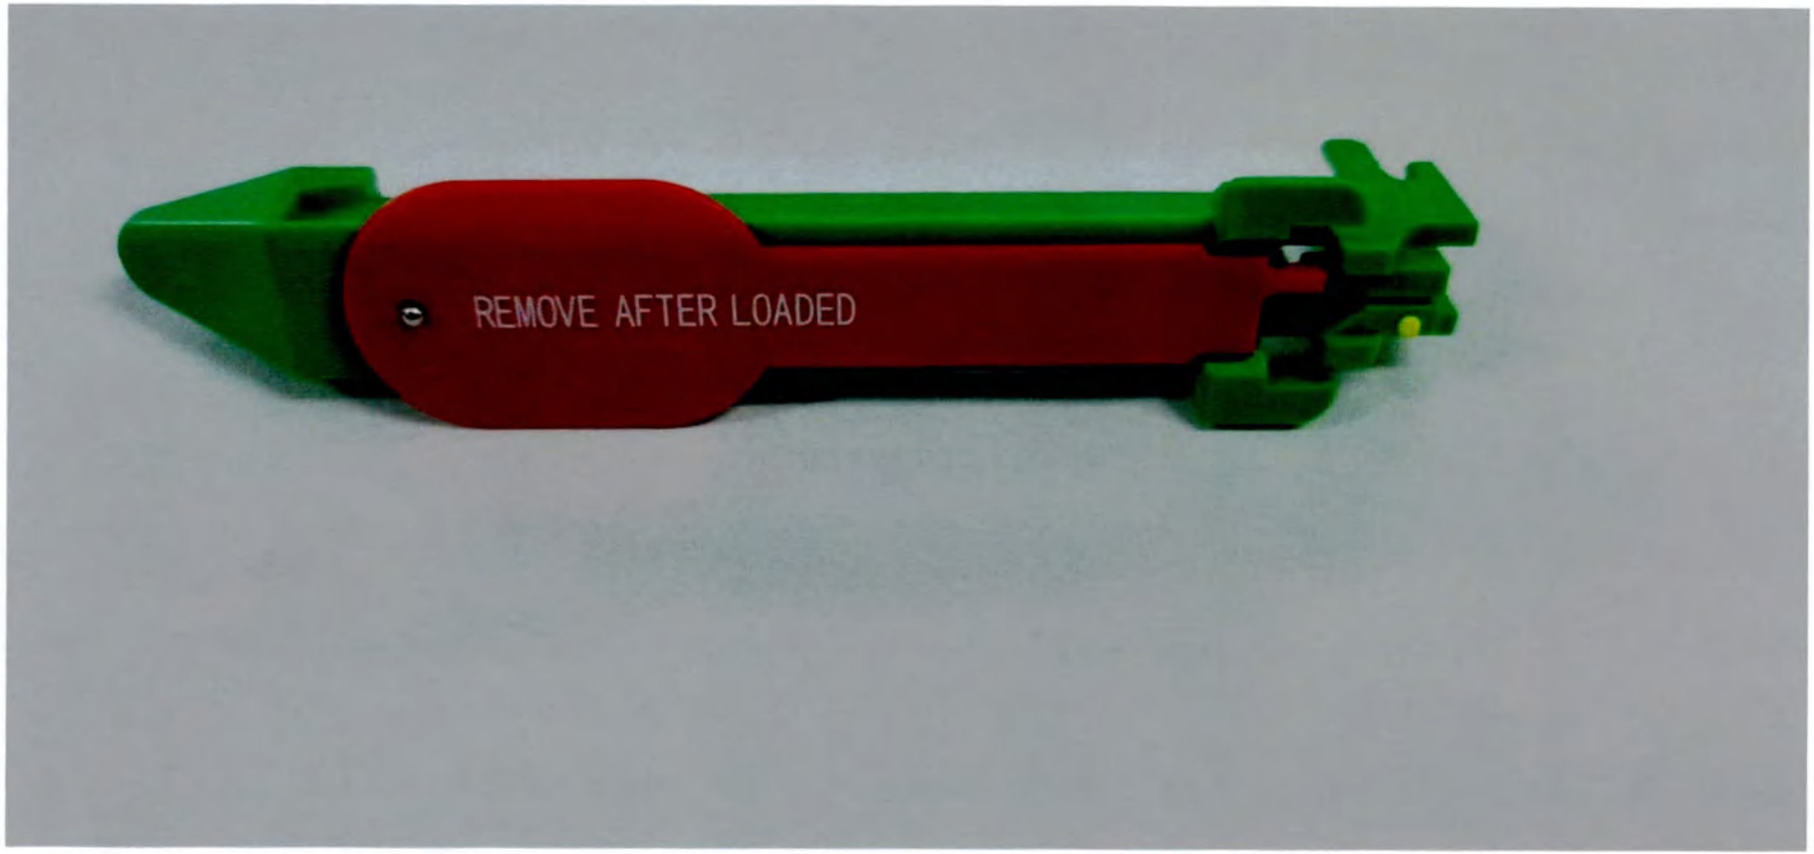

Рисунок 103 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 104 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

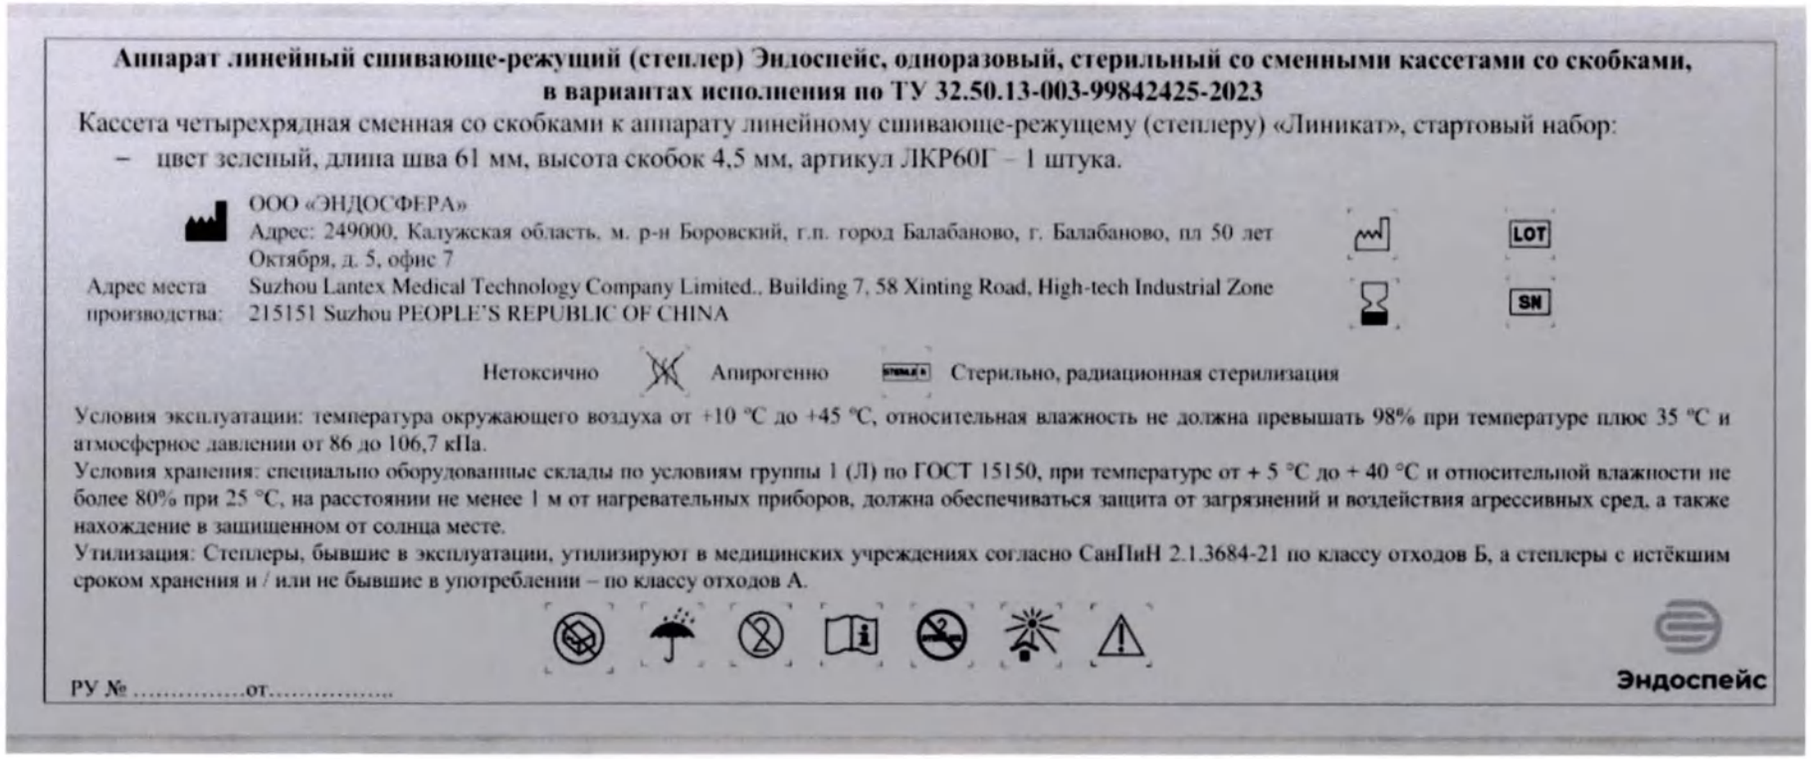

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 104А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

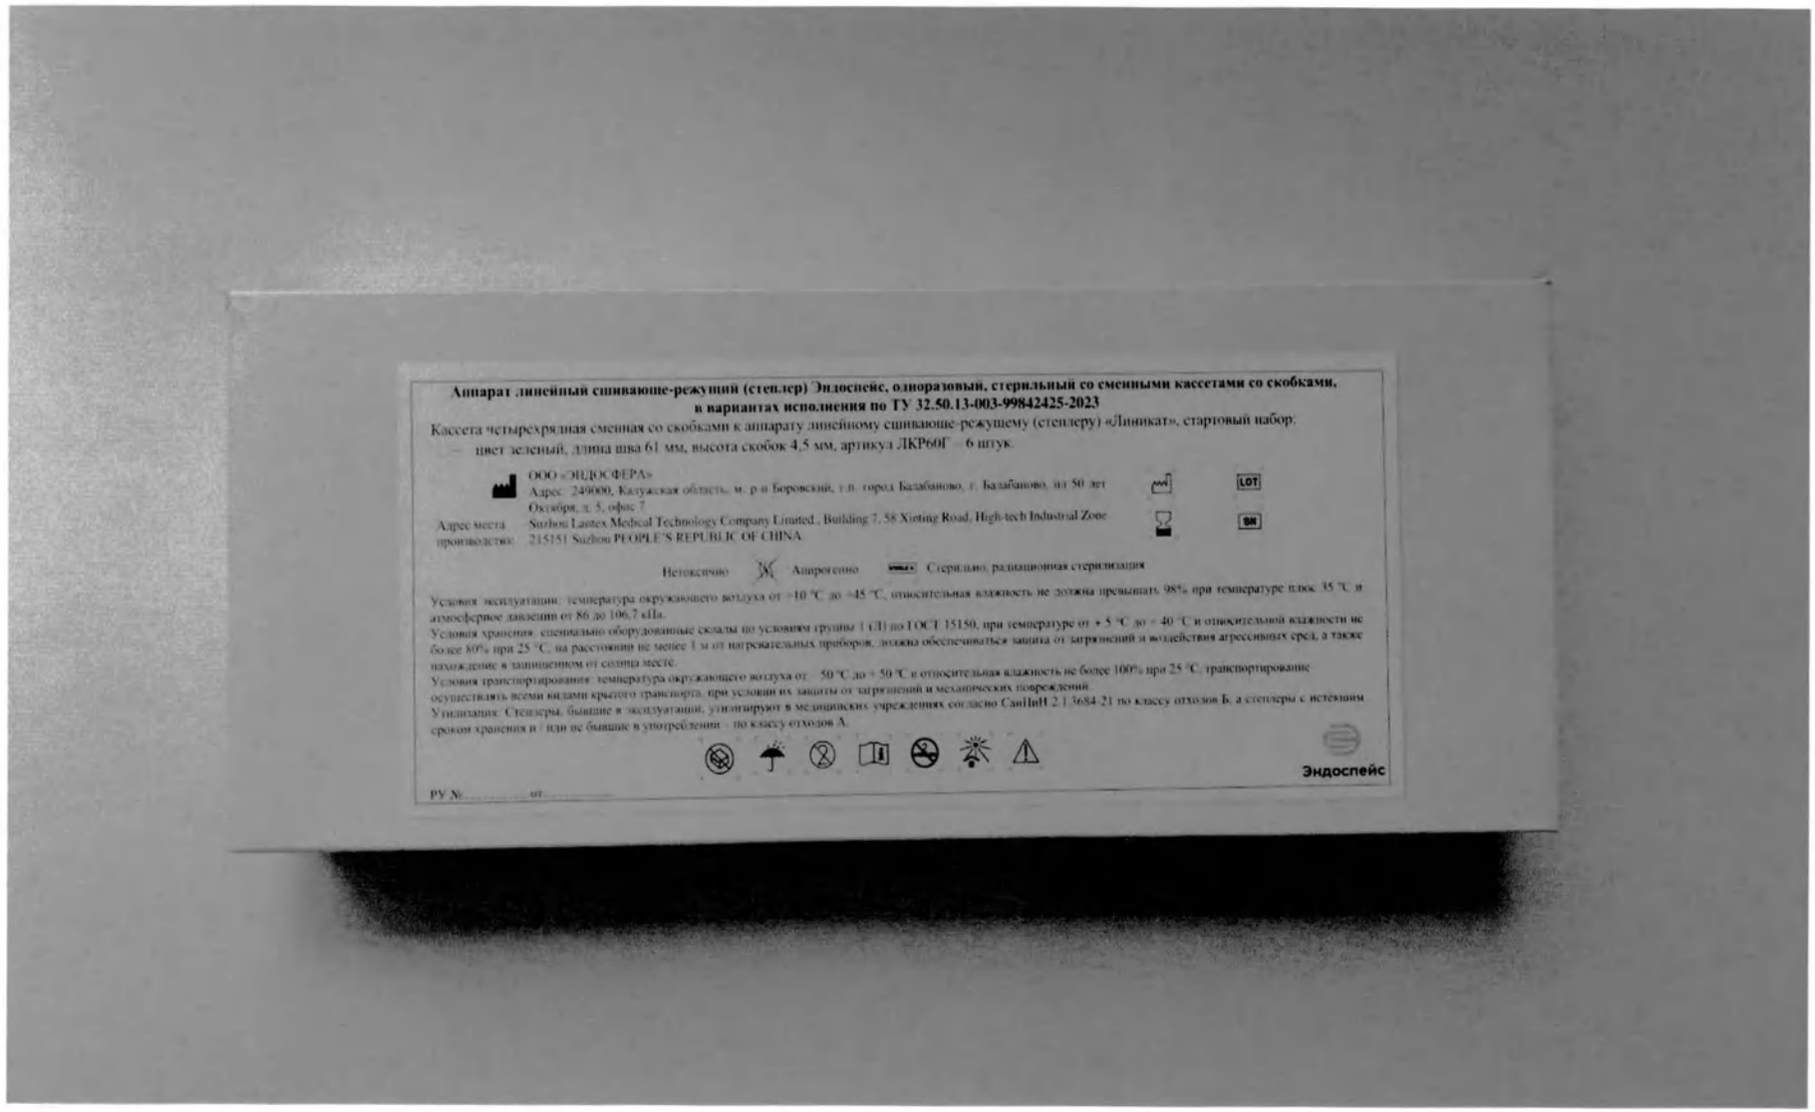

Рисунок 105 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

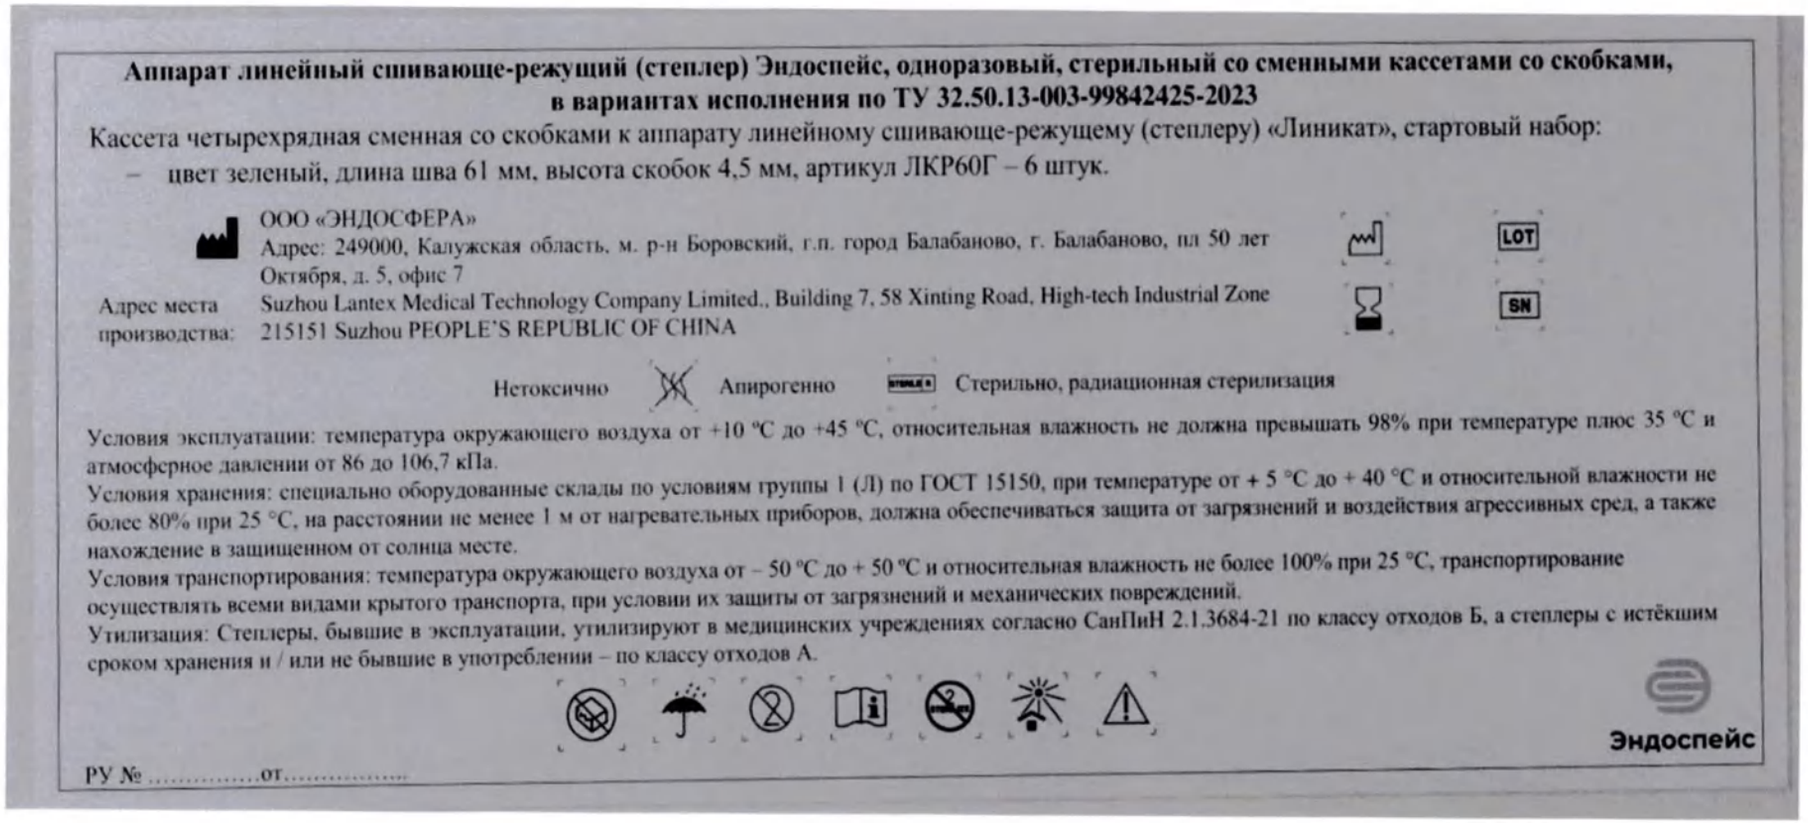

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно STERILE R Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 105А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 106 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

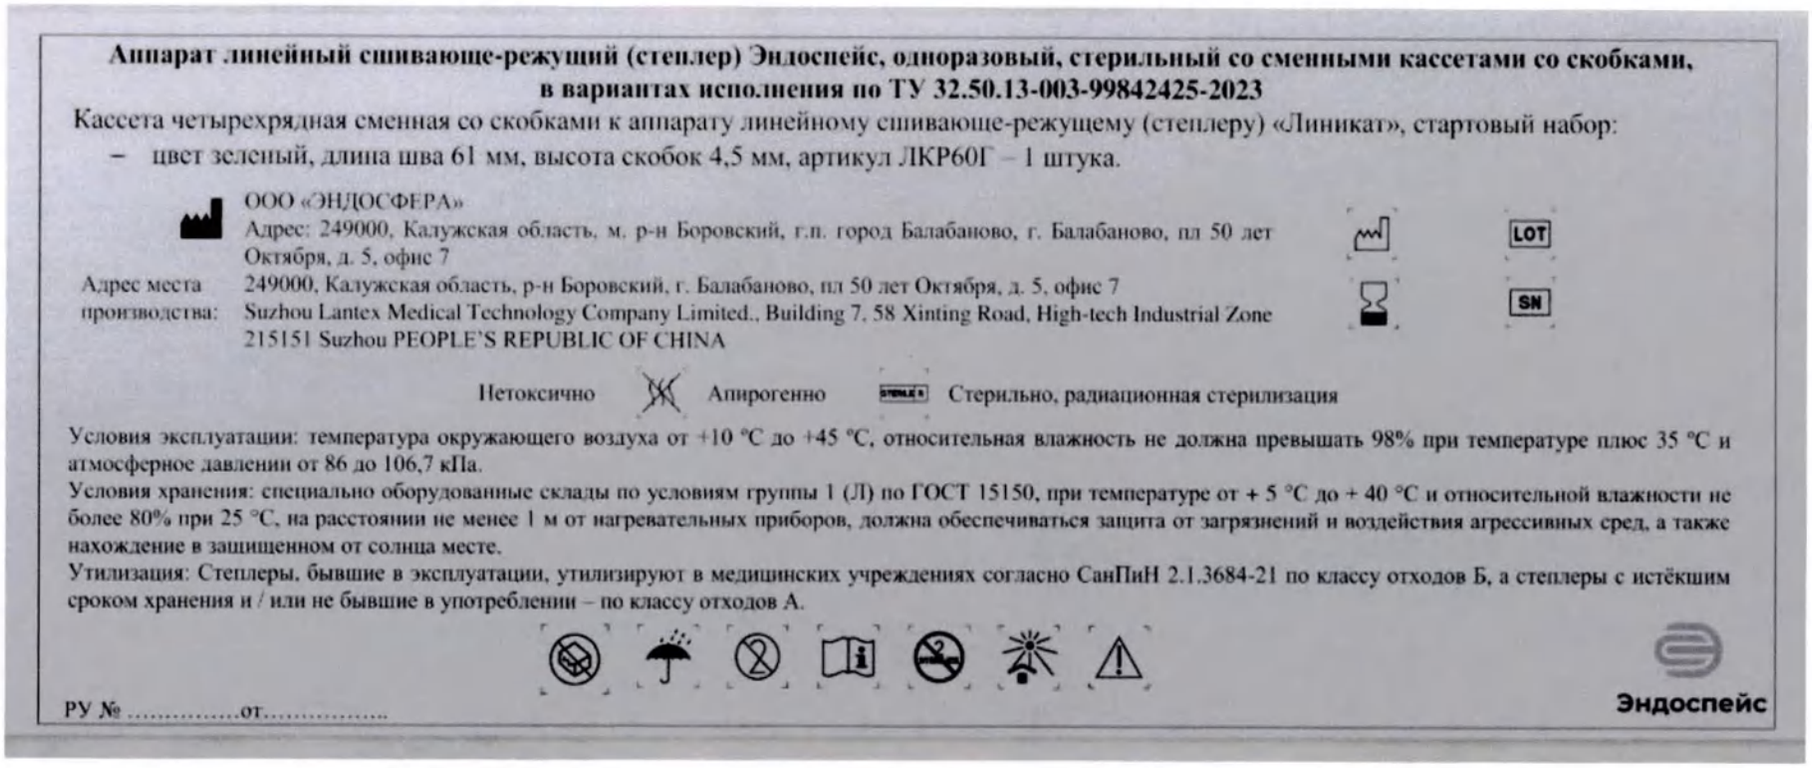

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 106А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 107 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

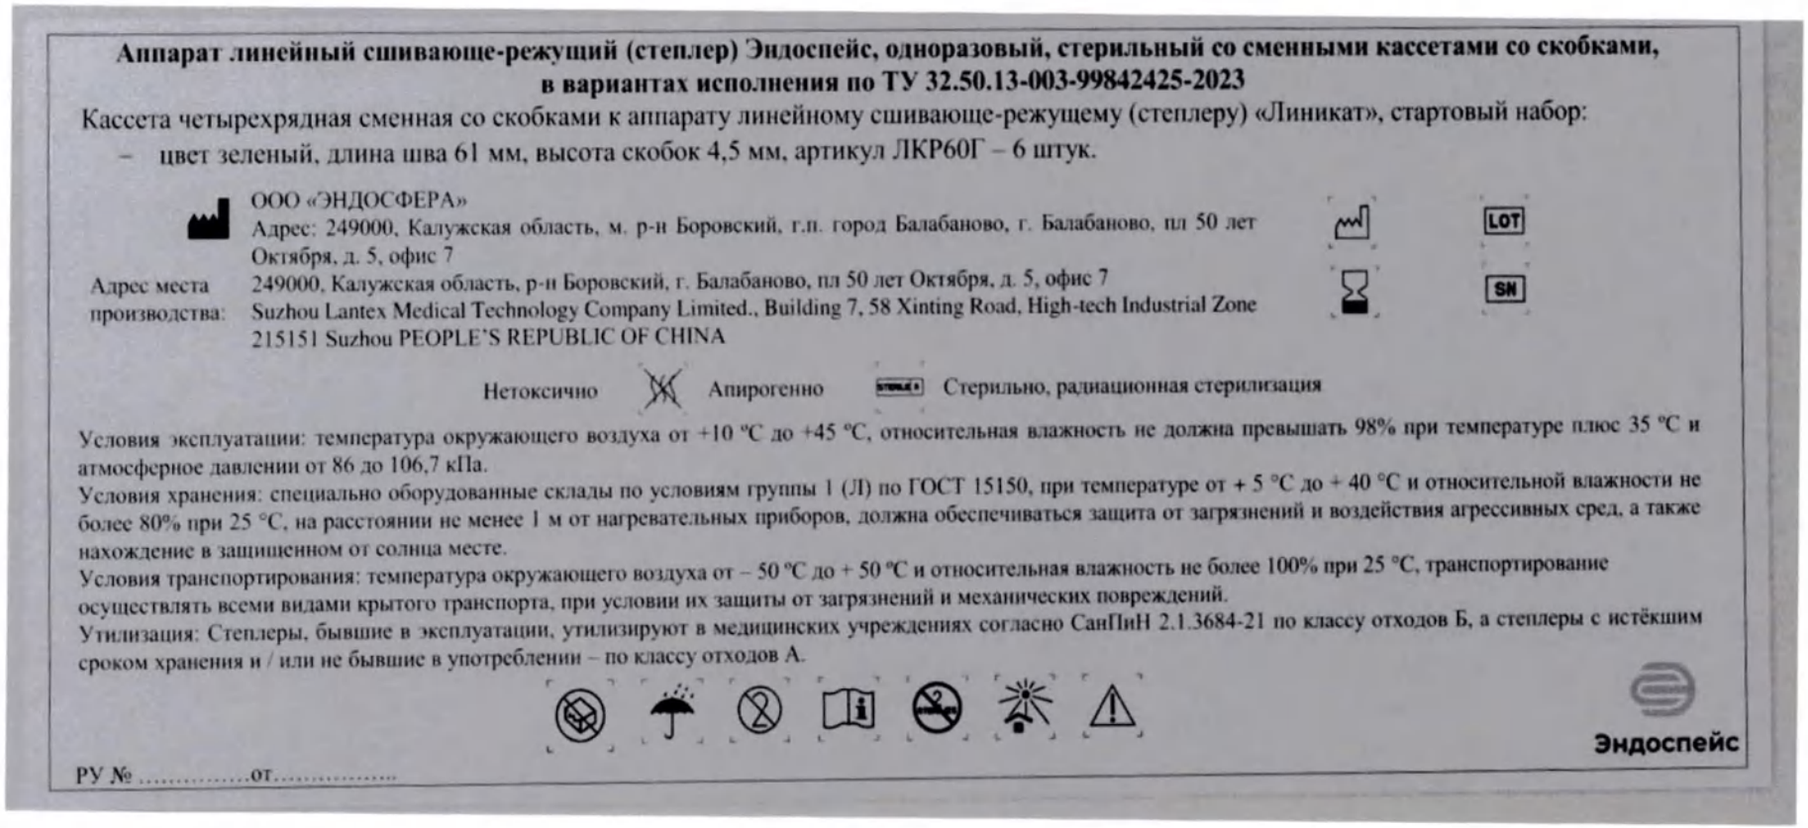

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 107А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 108 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

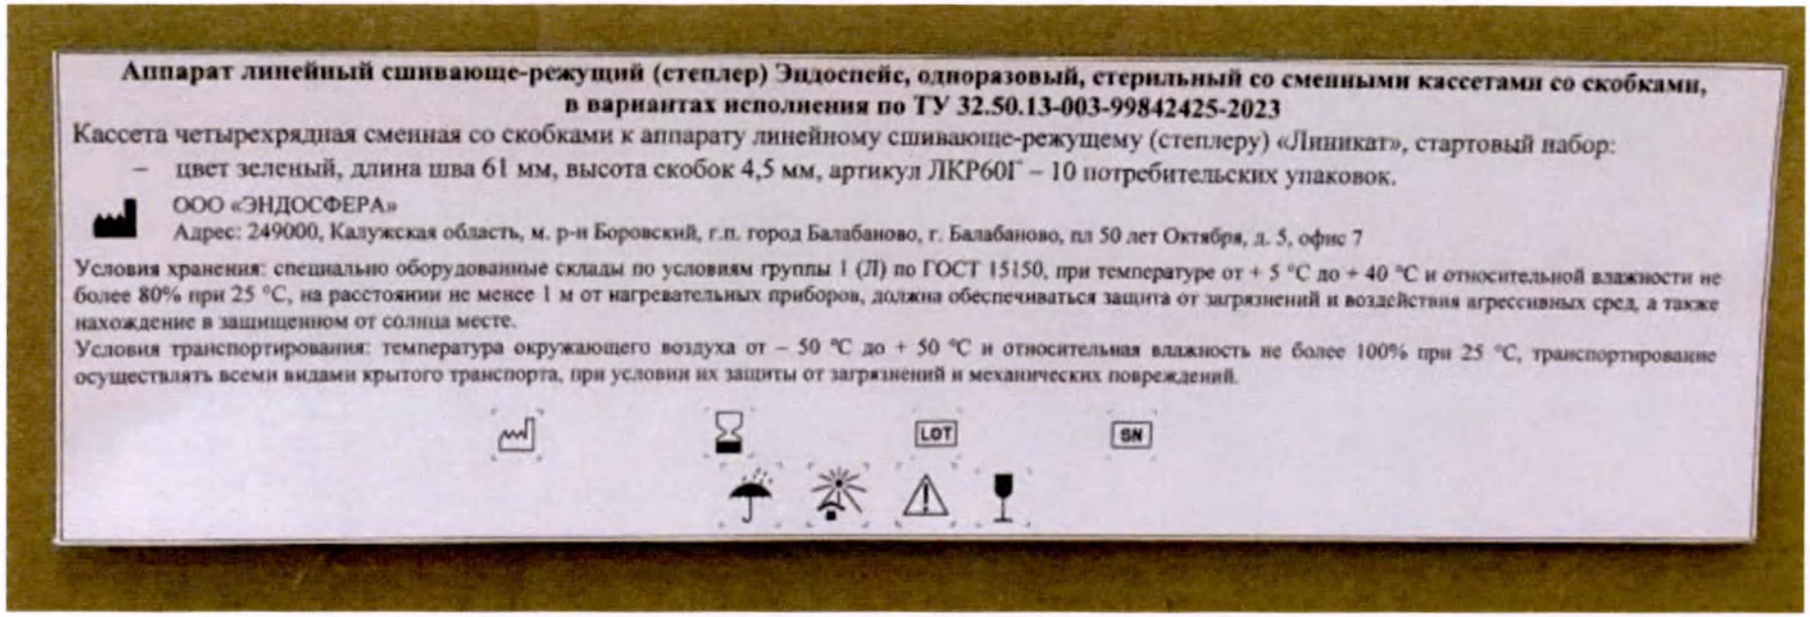

Рисунок 108А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 61 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

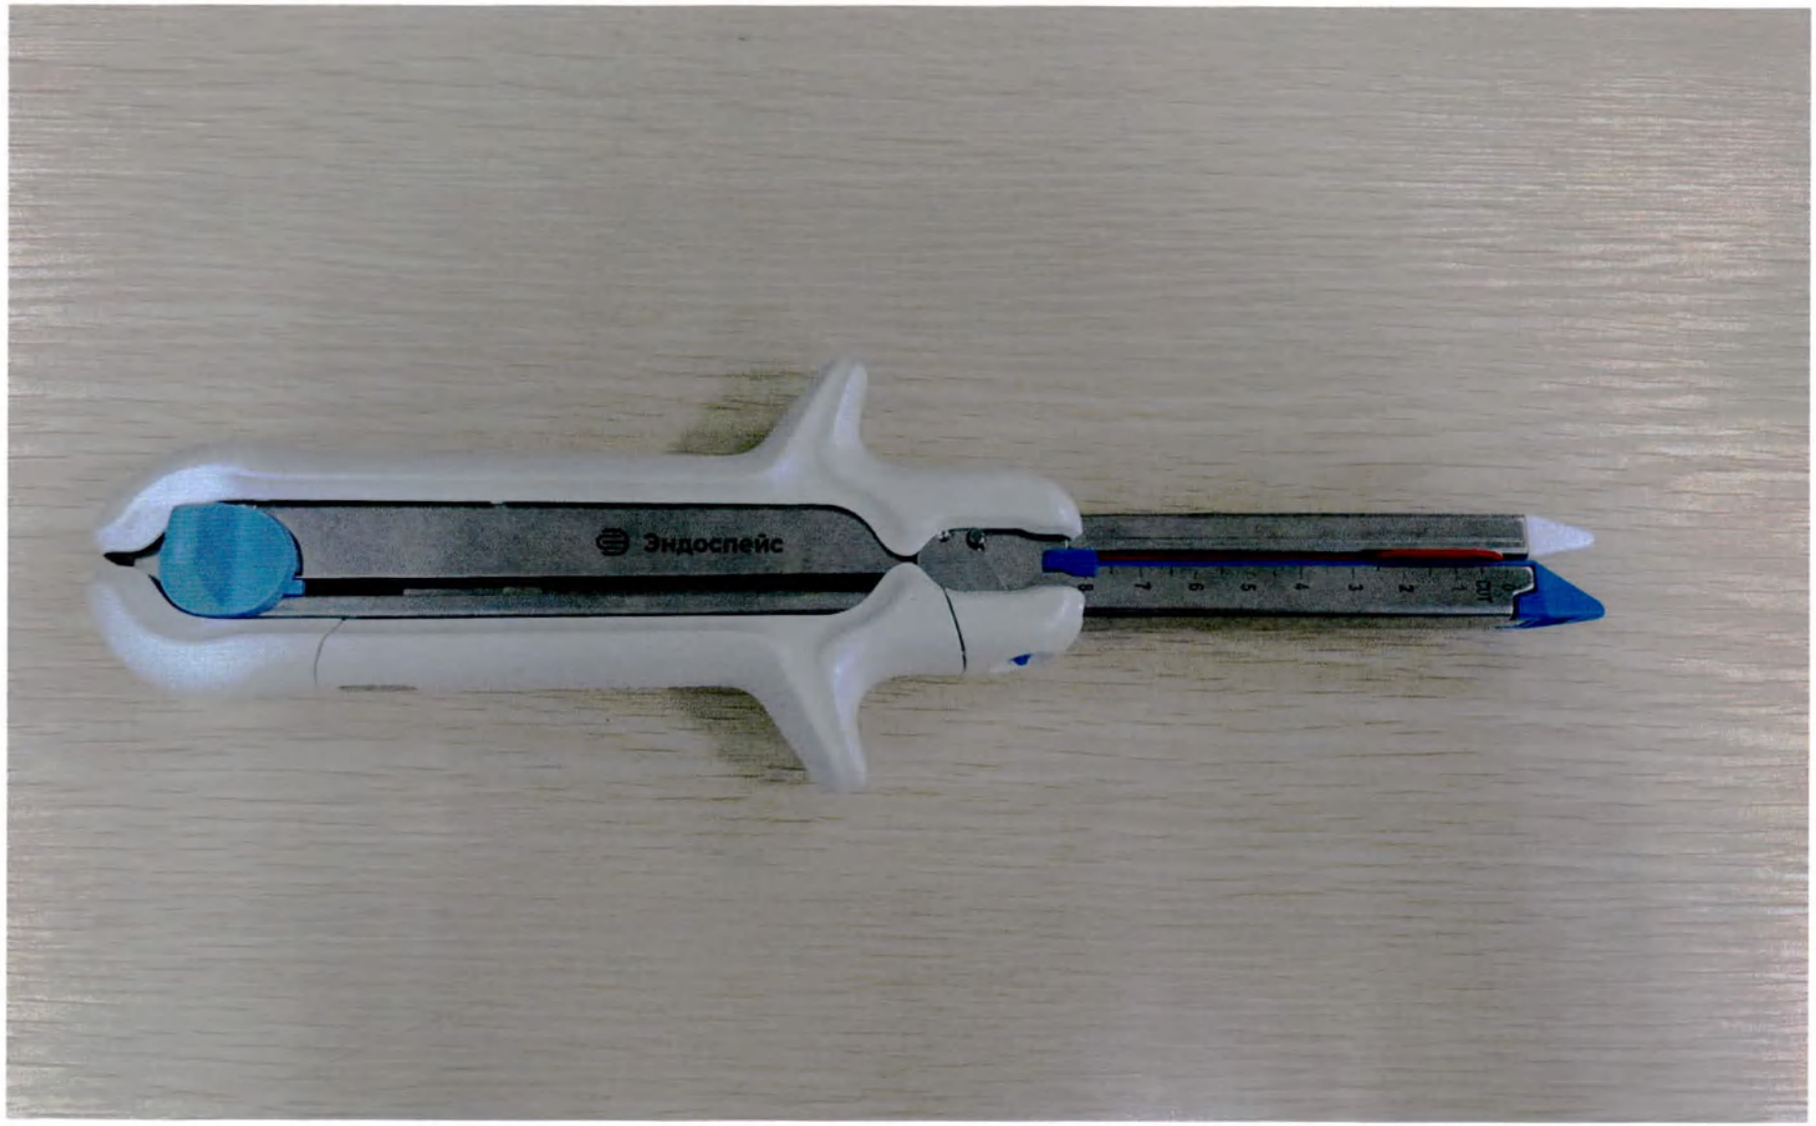

Рисунок 109 – Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

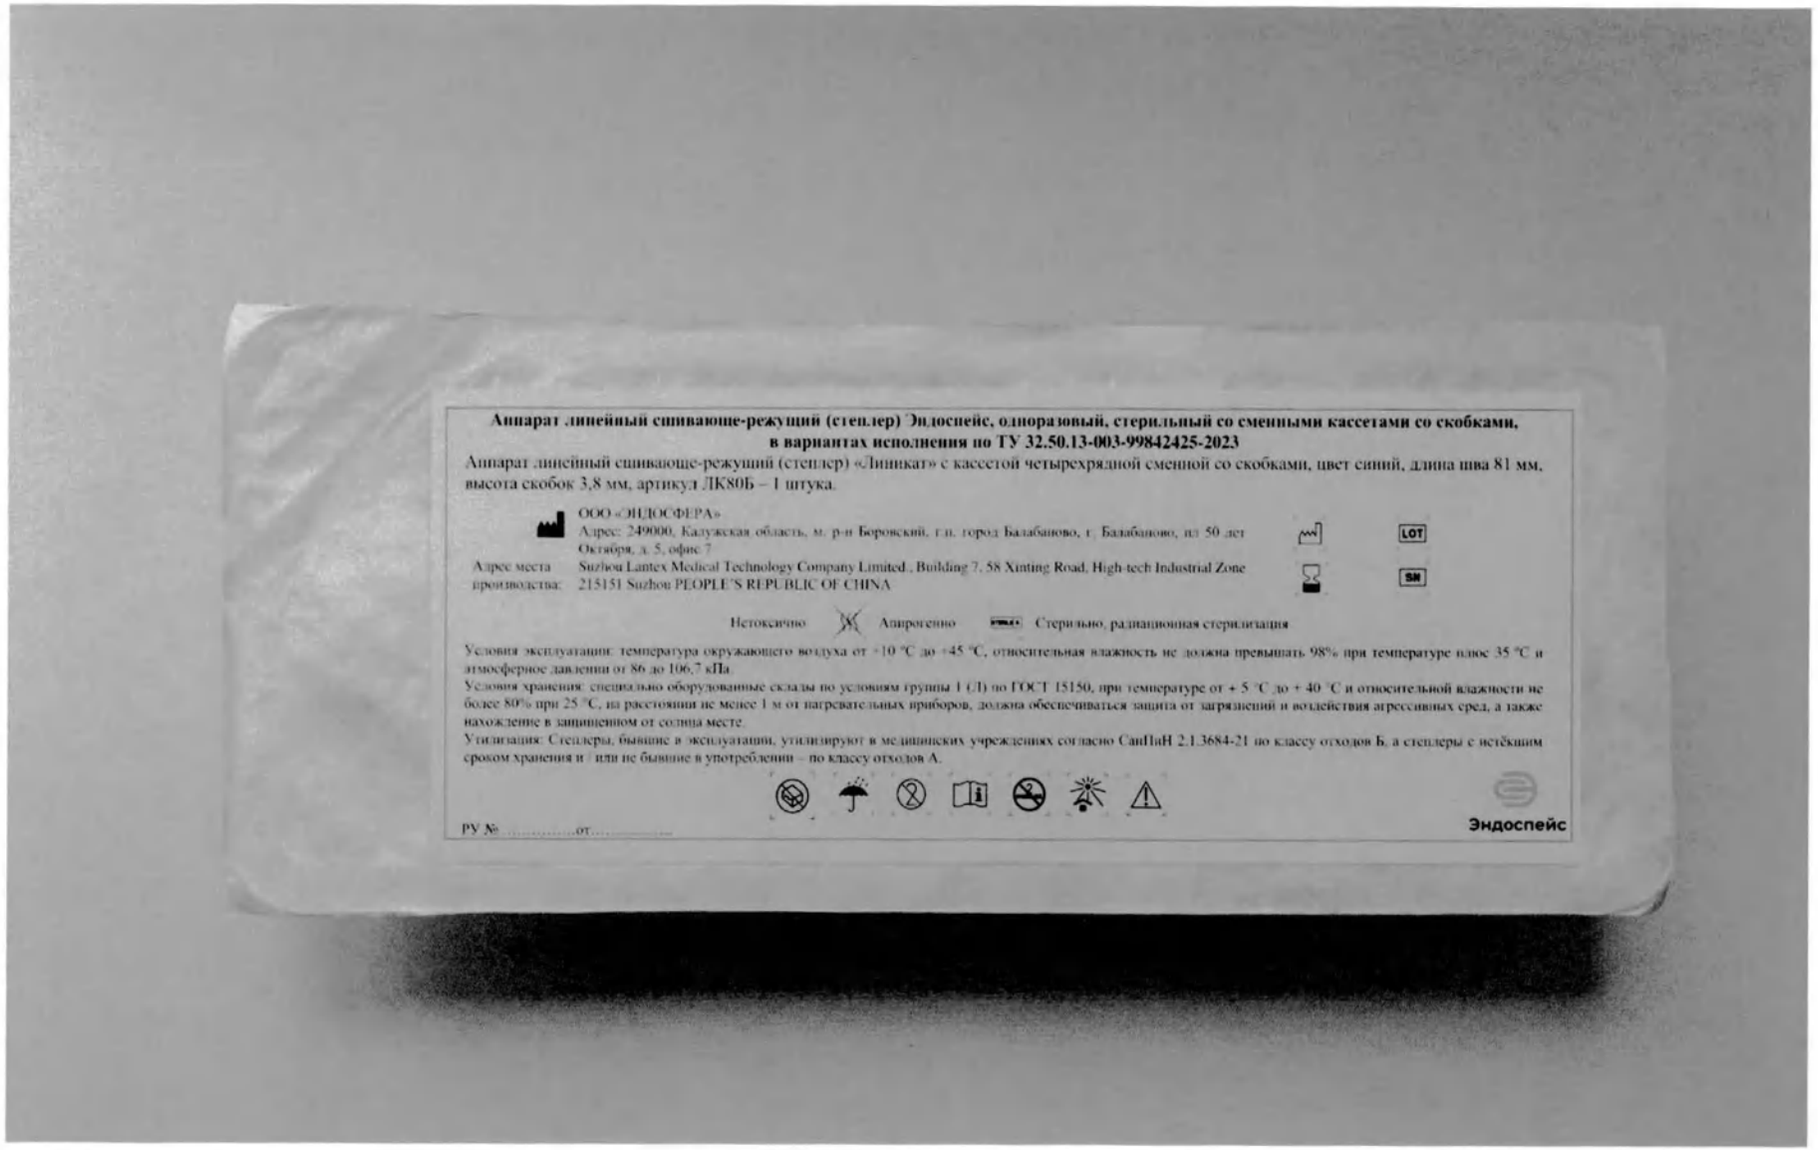

Рисунок 110 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

Рисунок 110А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

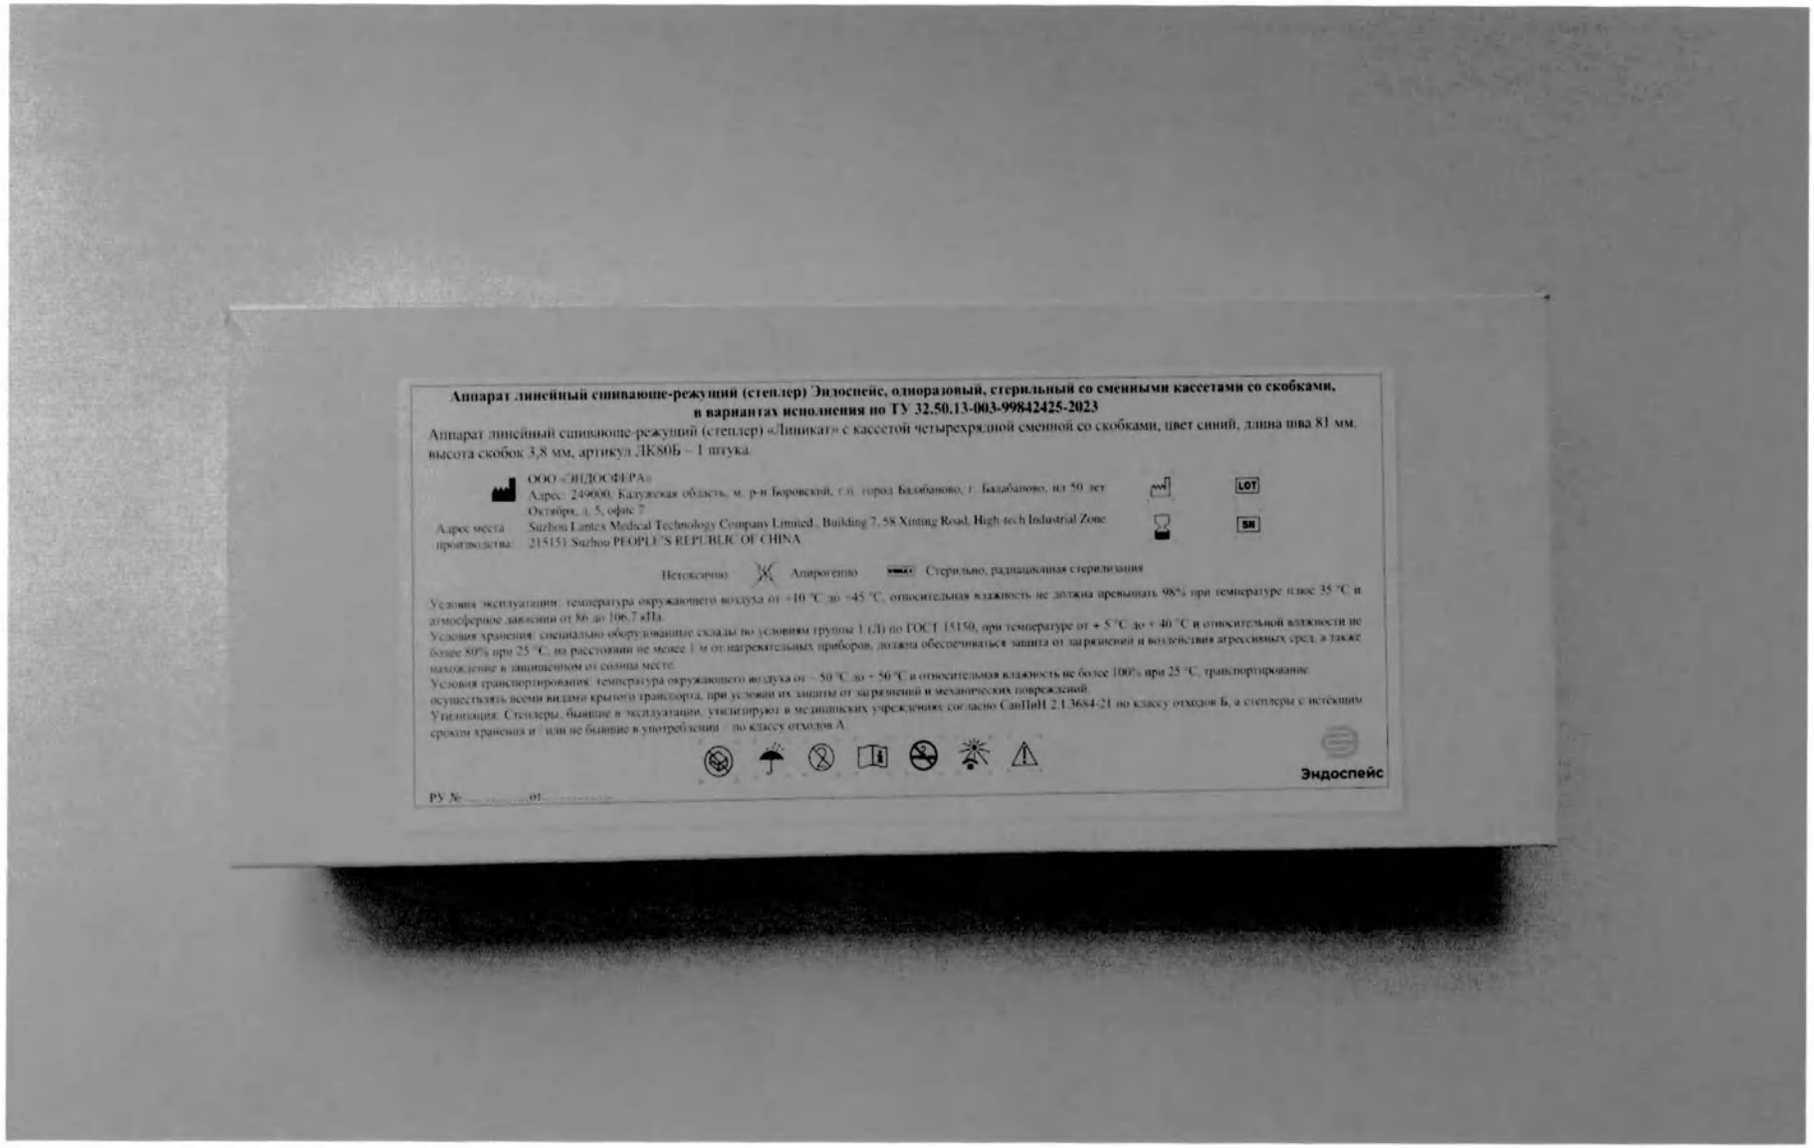

Рисунок 111 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

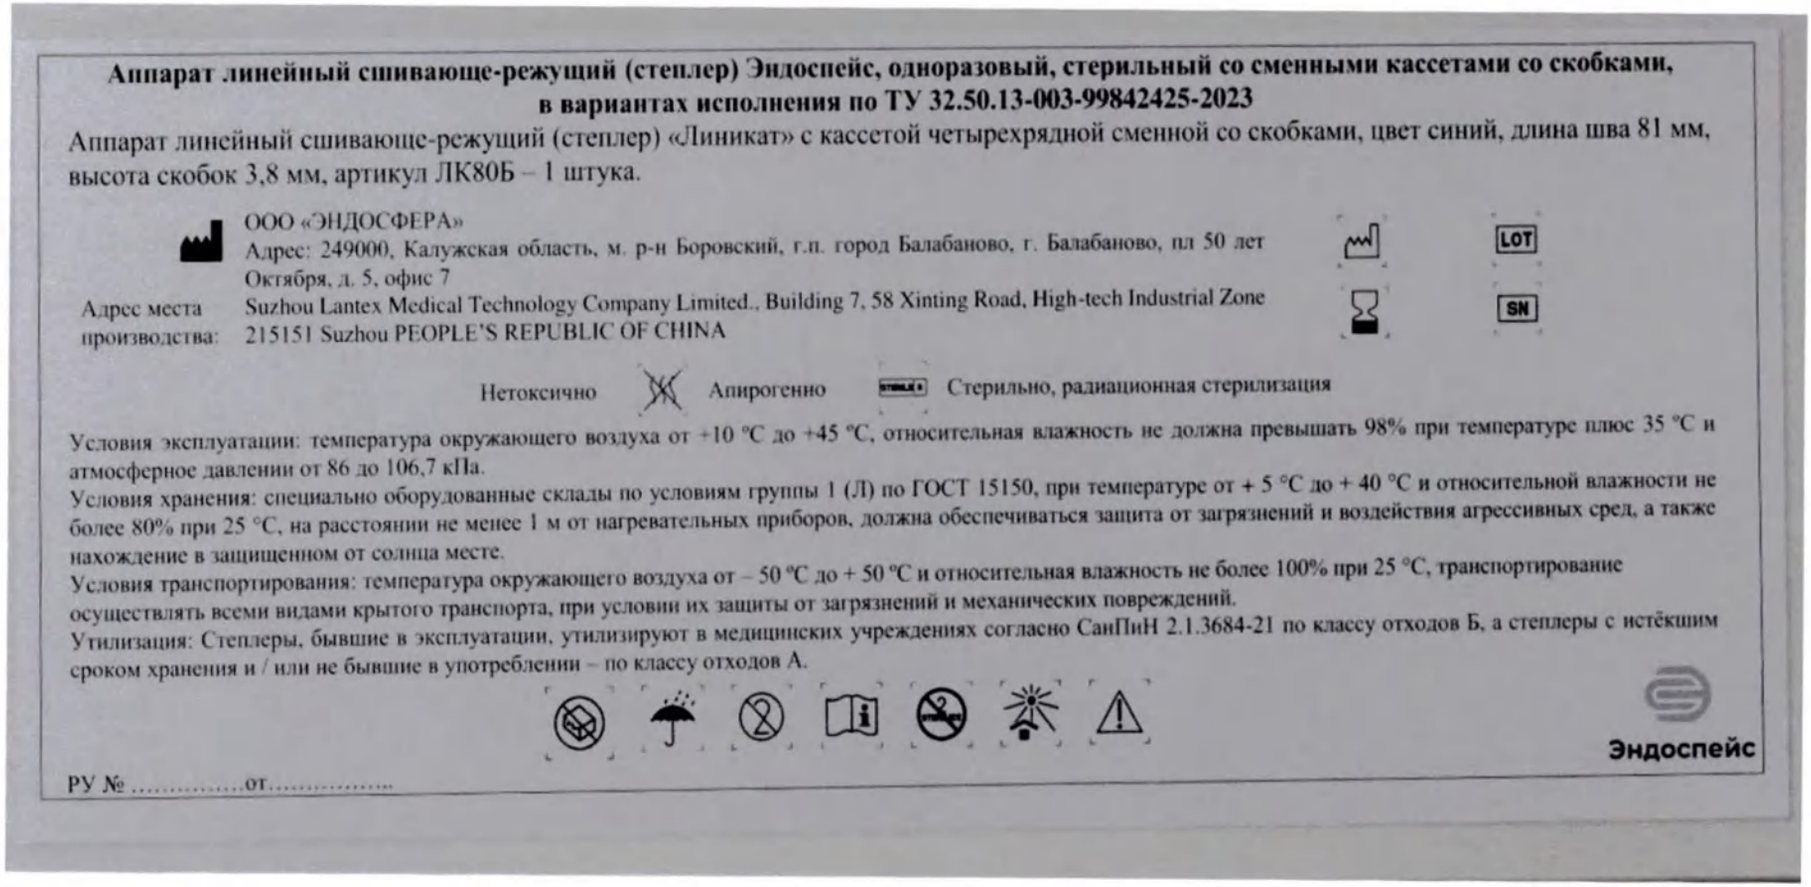

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 111А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

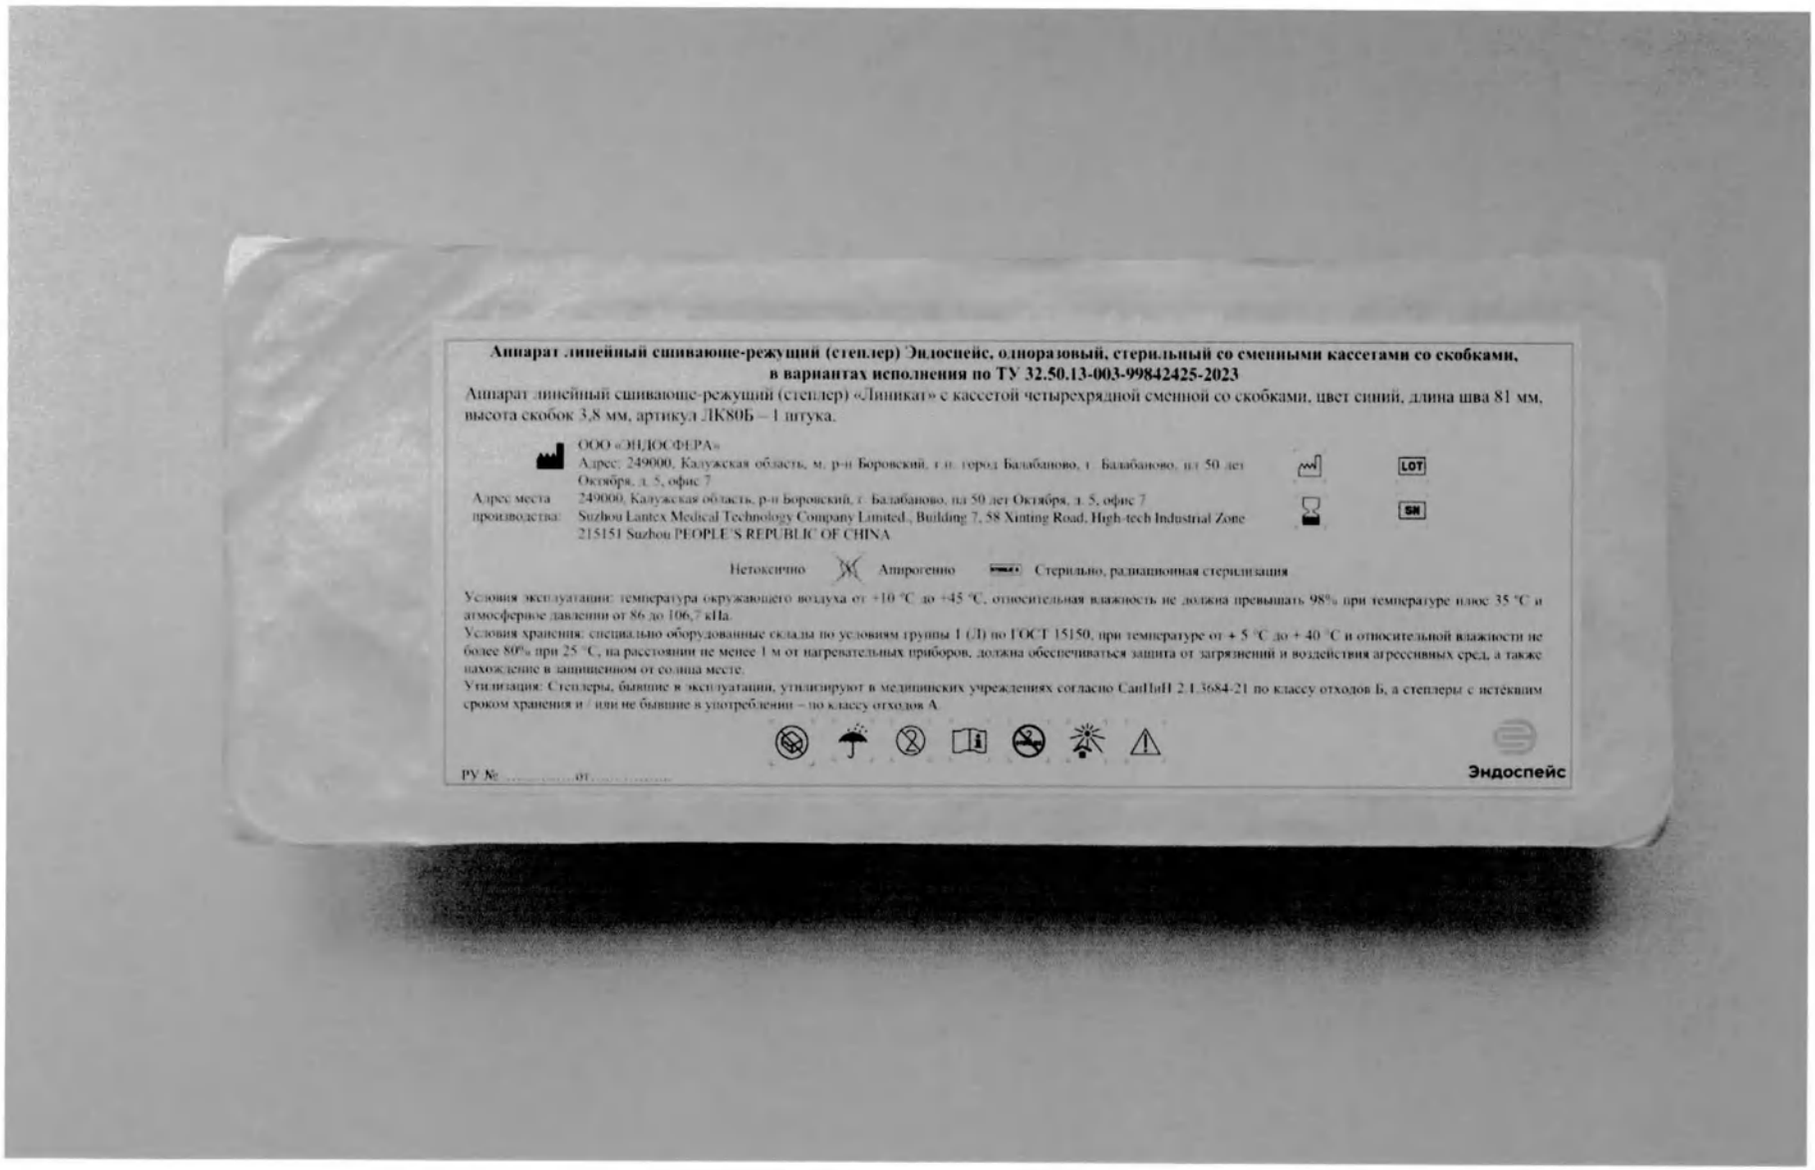

Рисунок 112 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно STERILE R Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 112А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

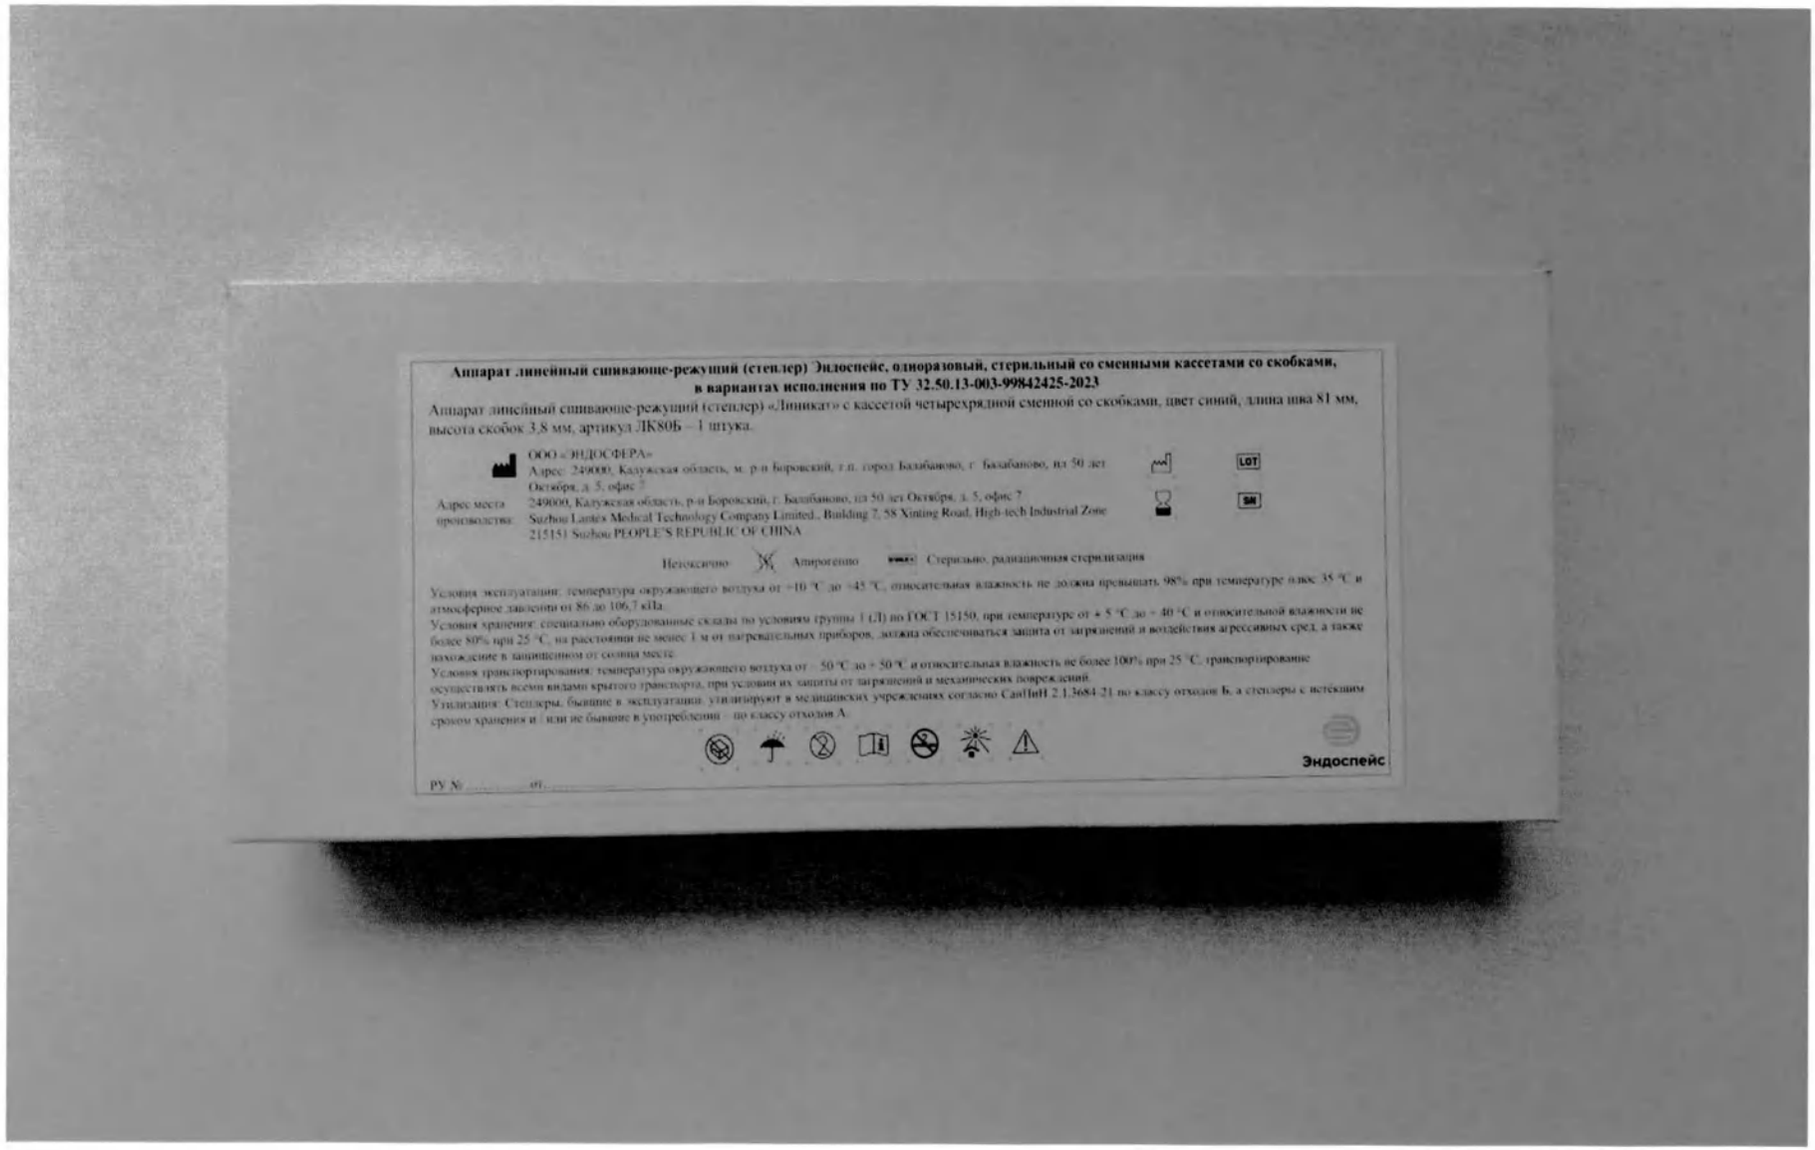

Рисунок 113 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 113А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

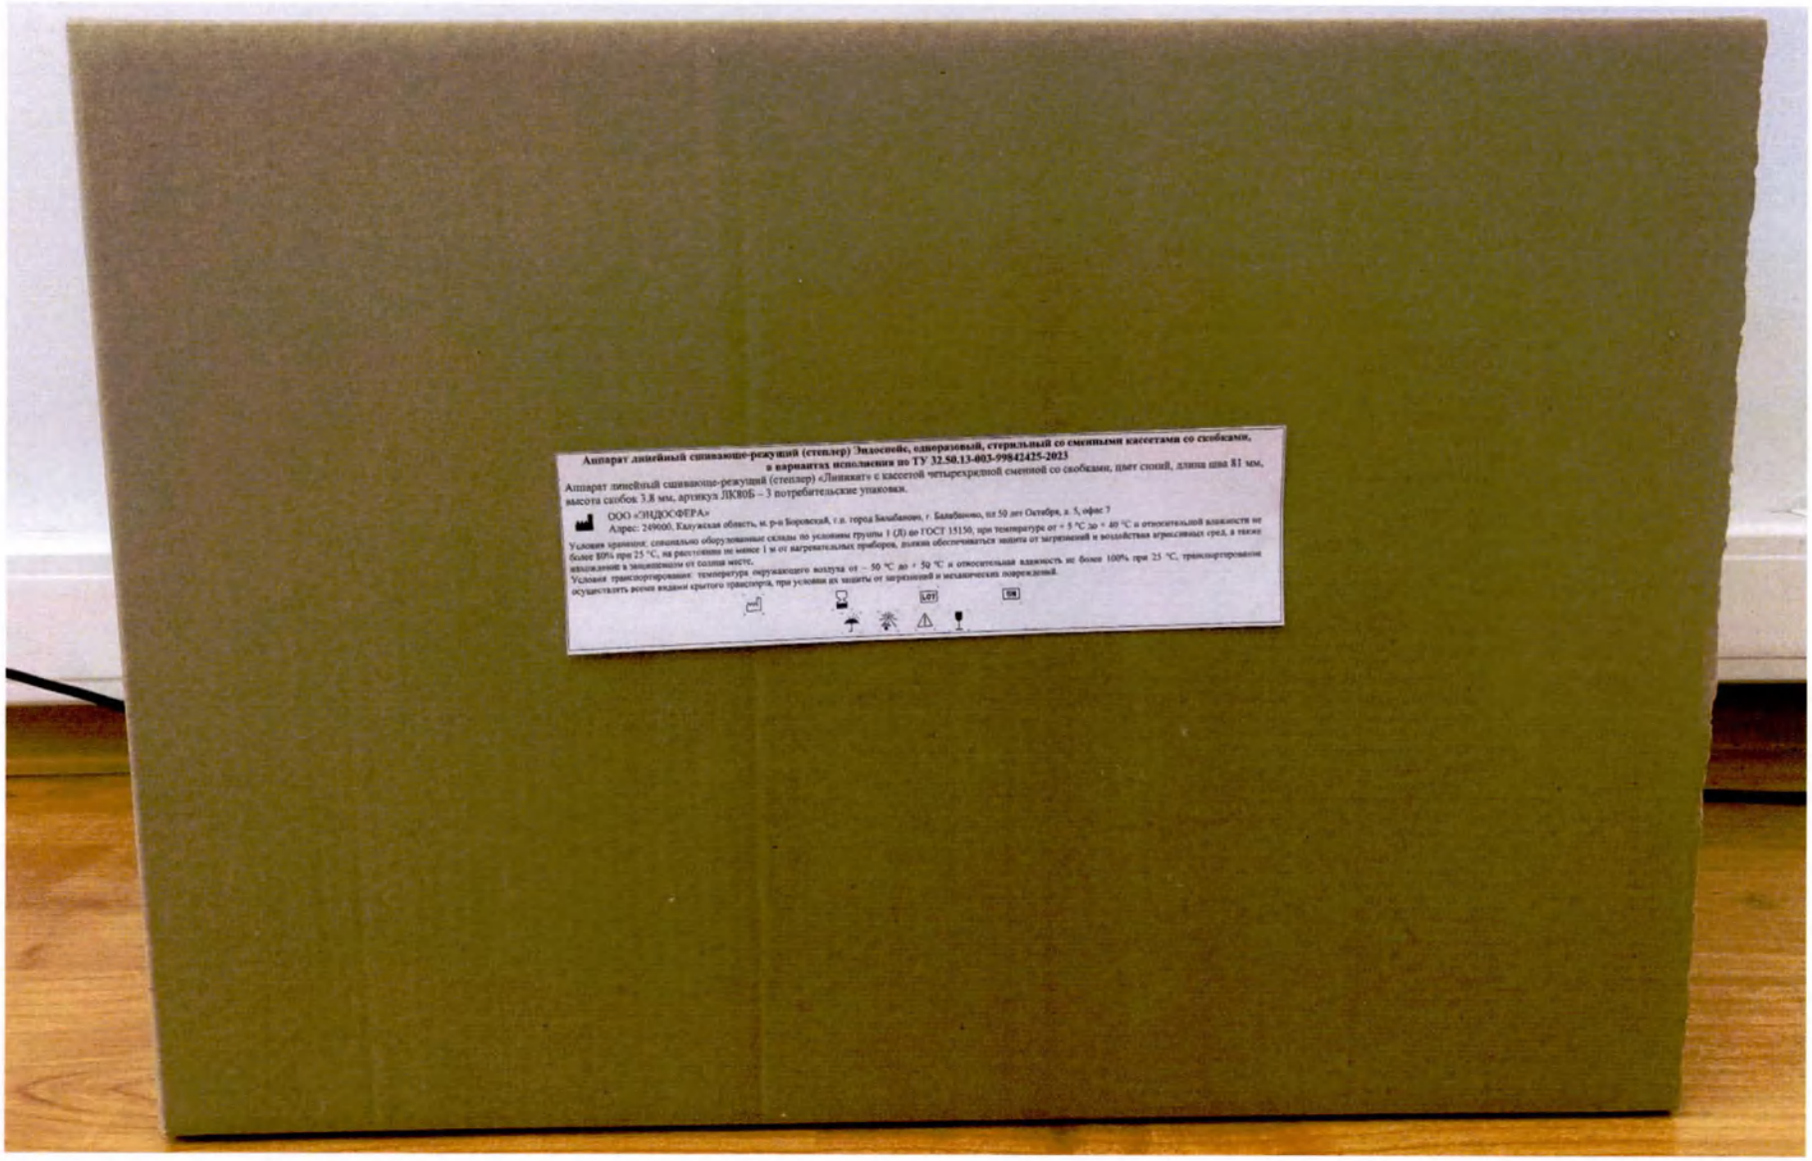

Рисунок 114 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

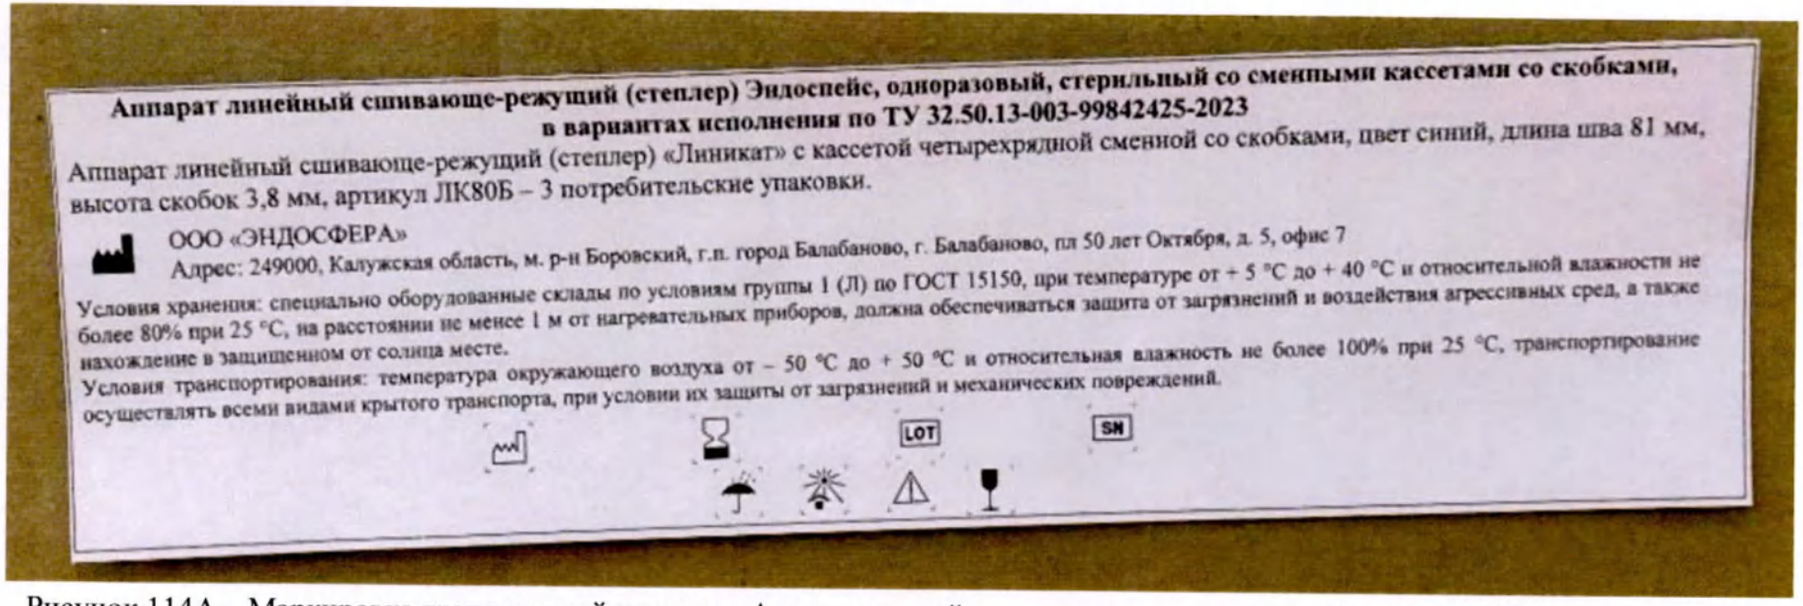

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

LOT SN

Рисунок 114А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

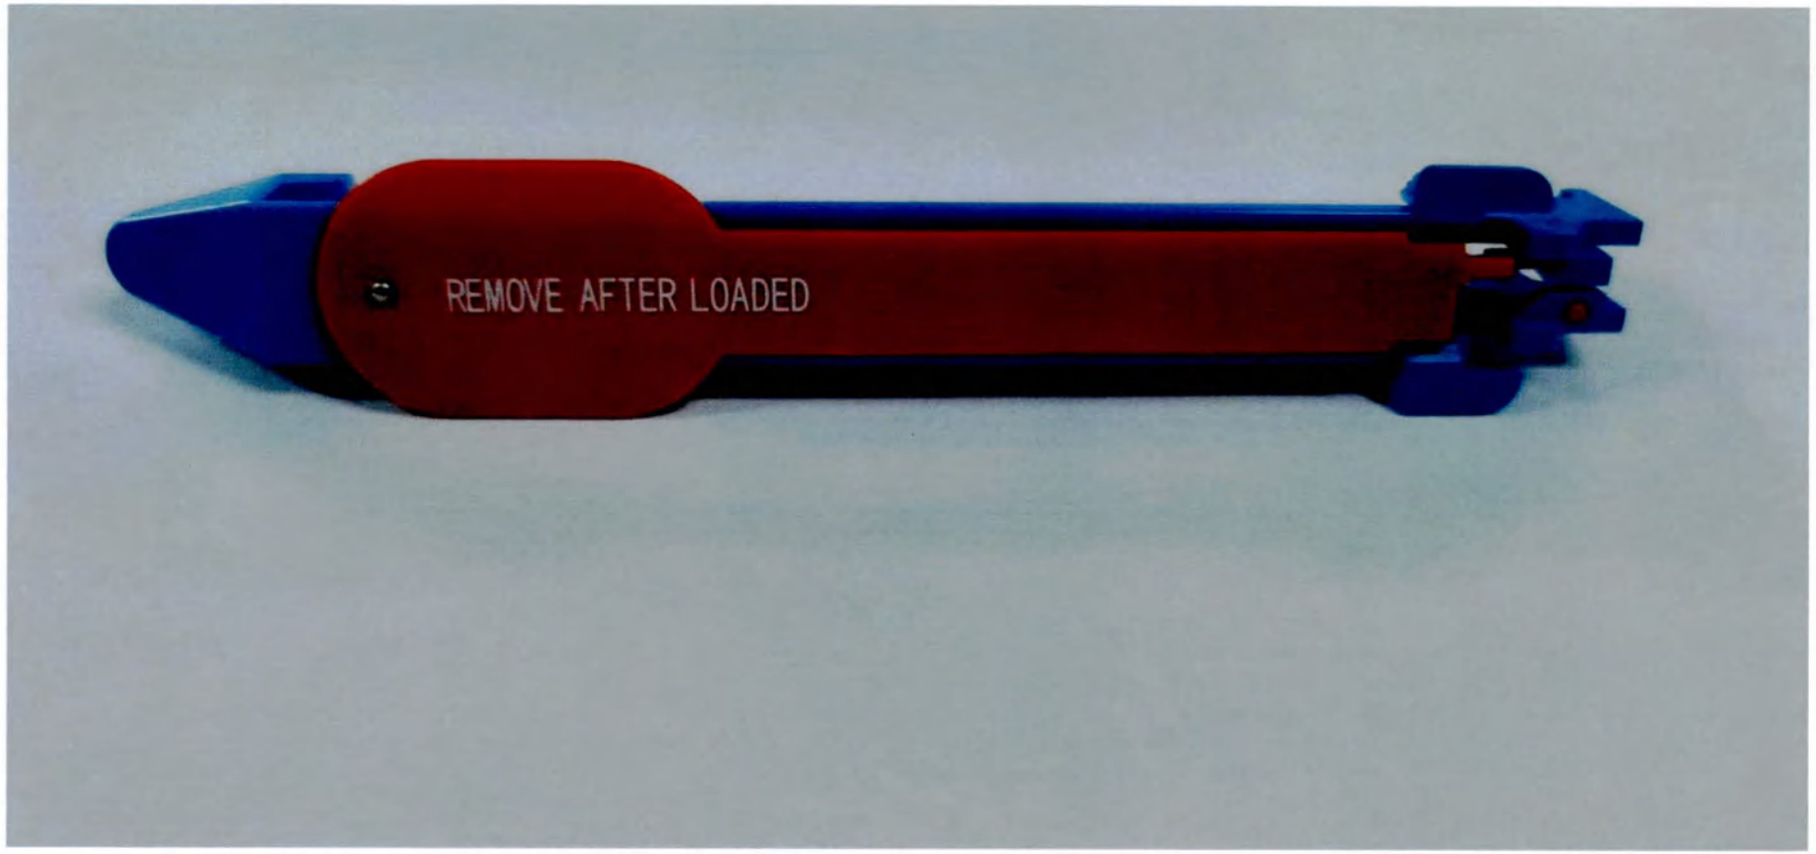

Рисунок 115 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 116 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

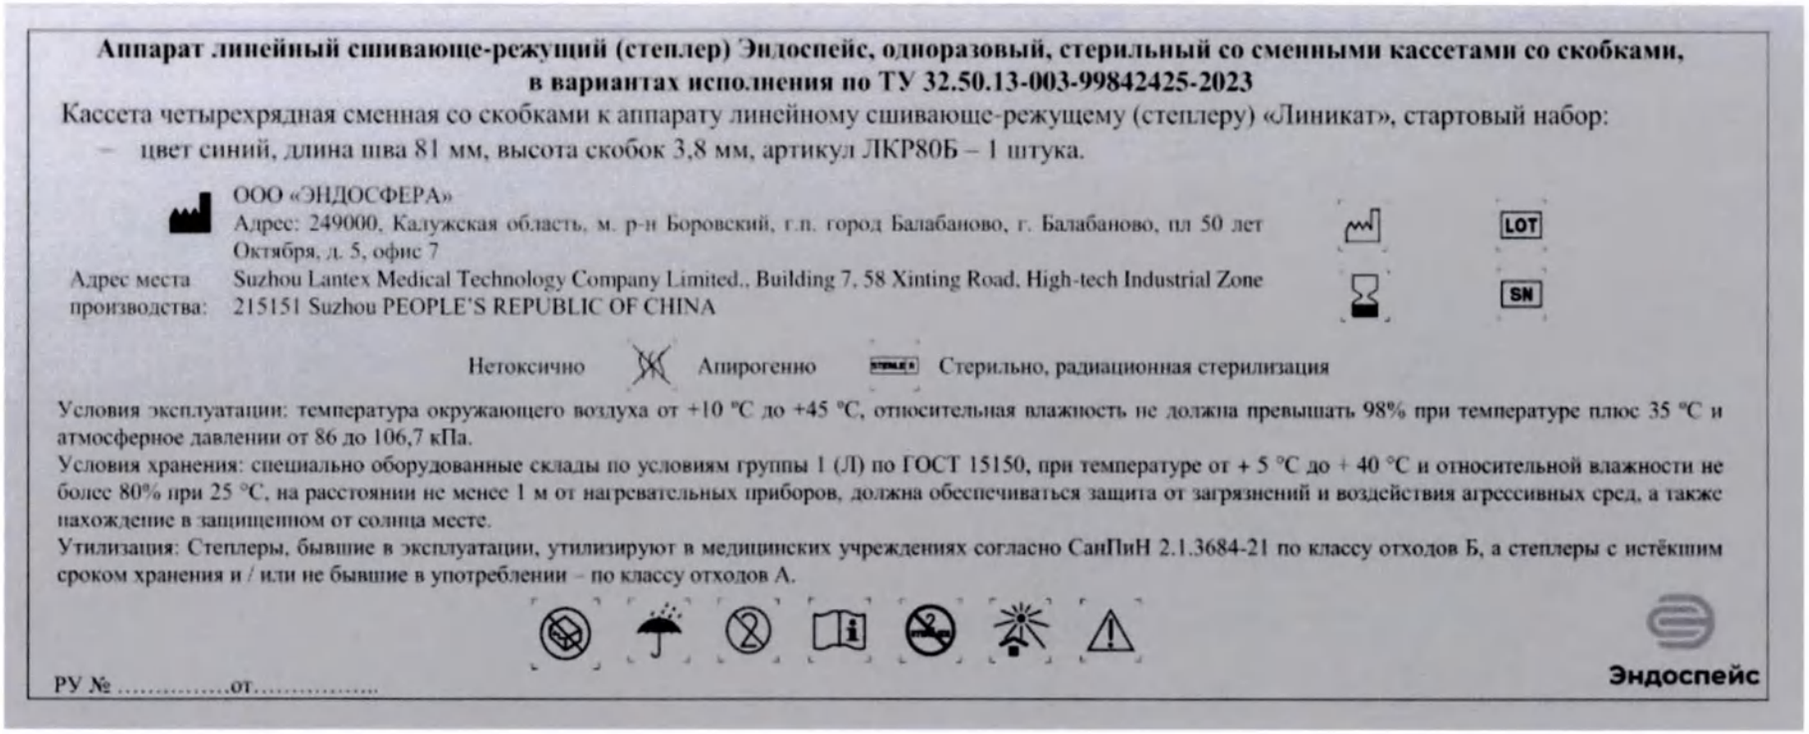

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 116А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

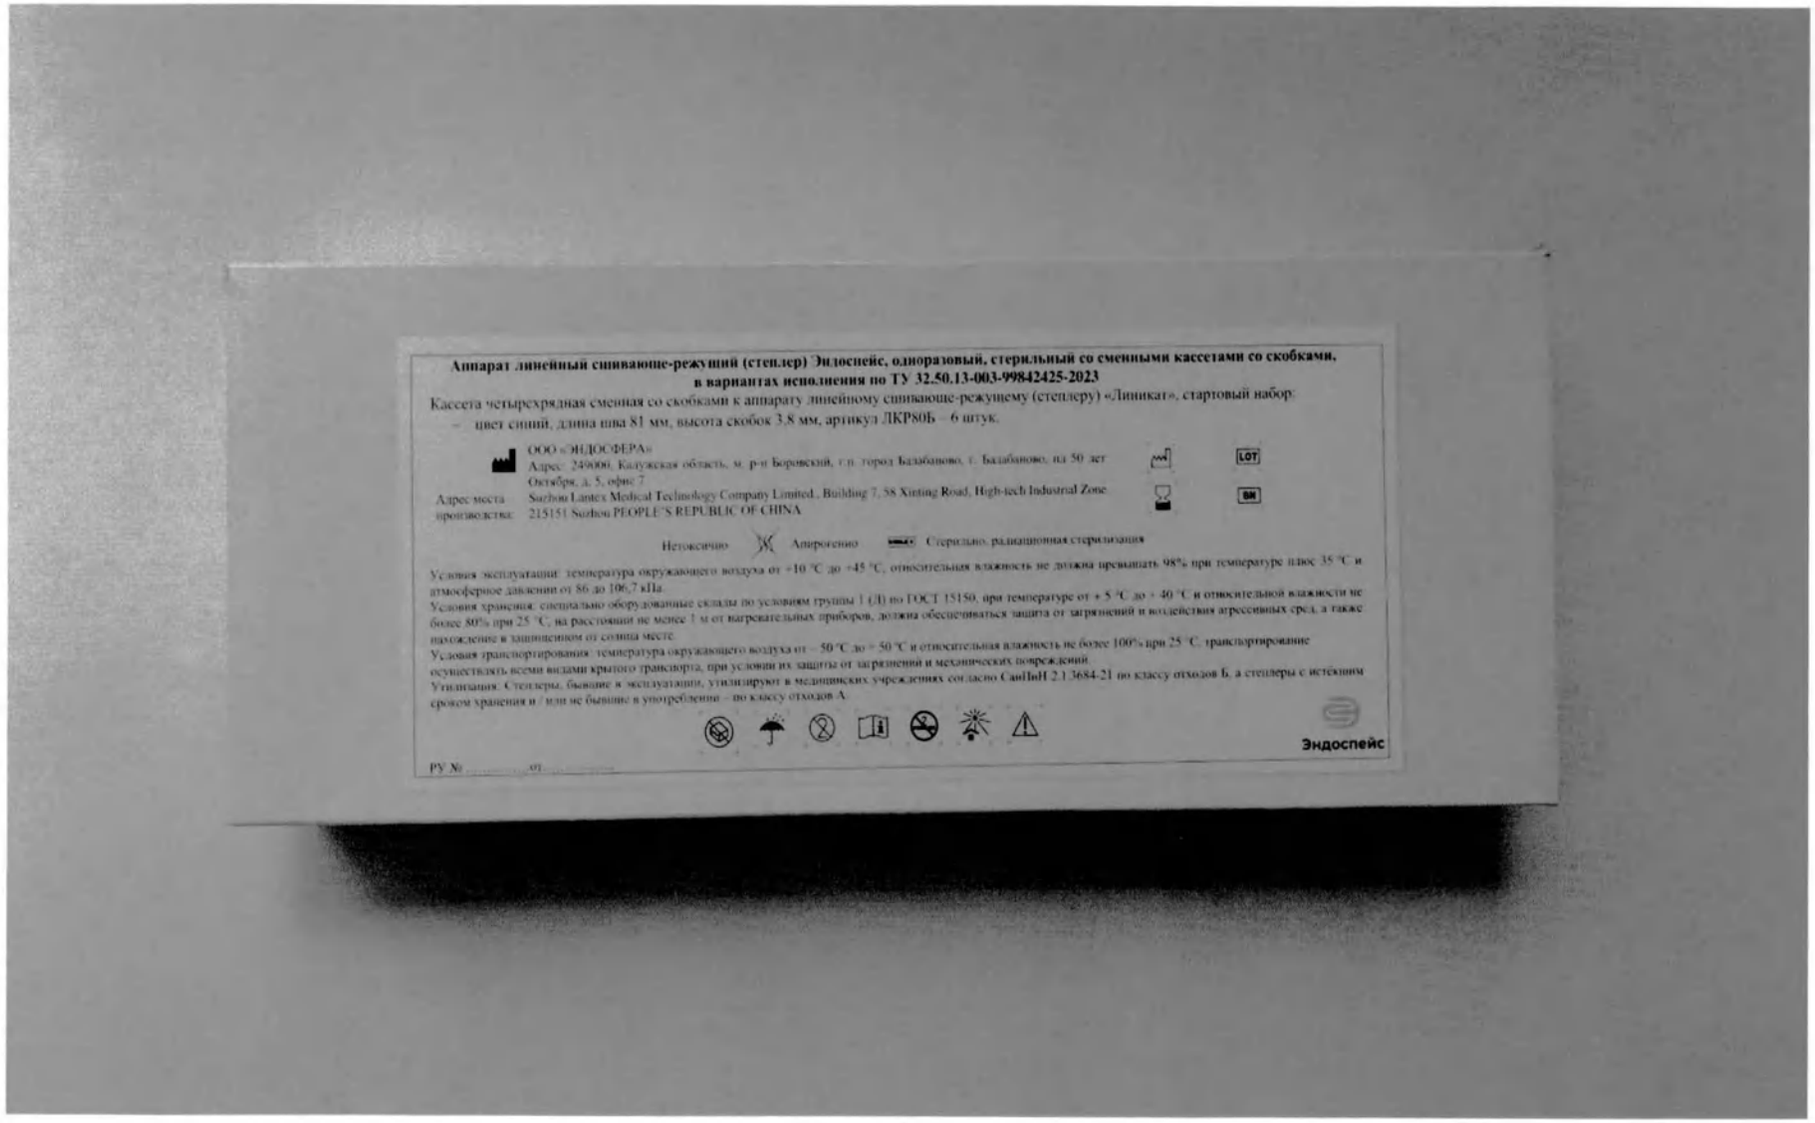

Рисунок 117 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

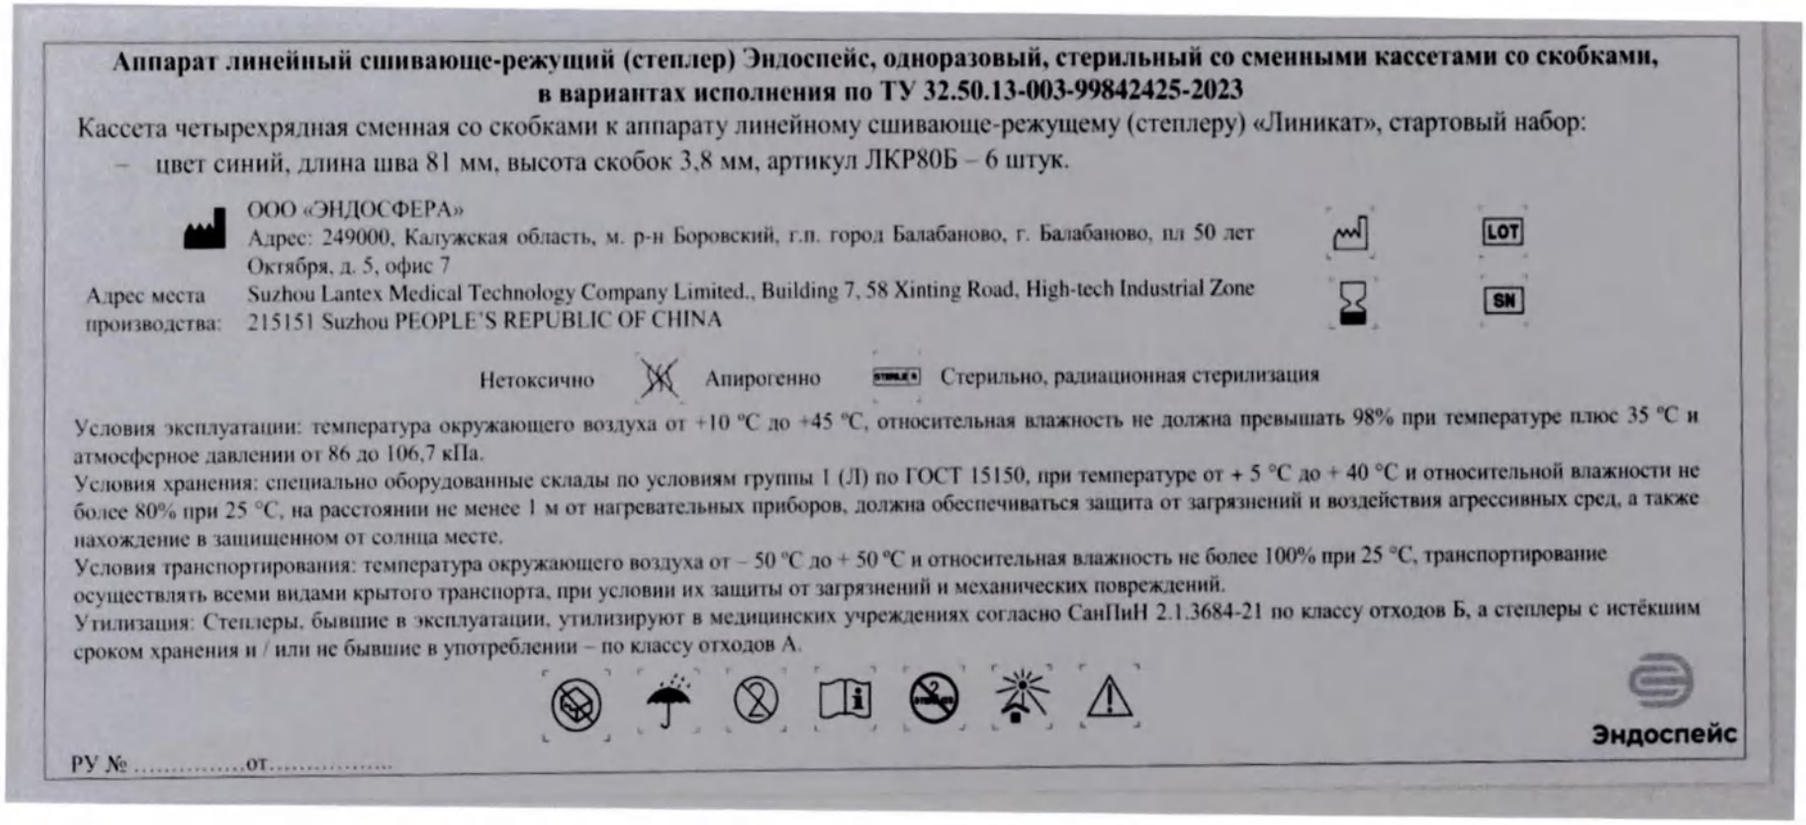

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 117А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 118 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

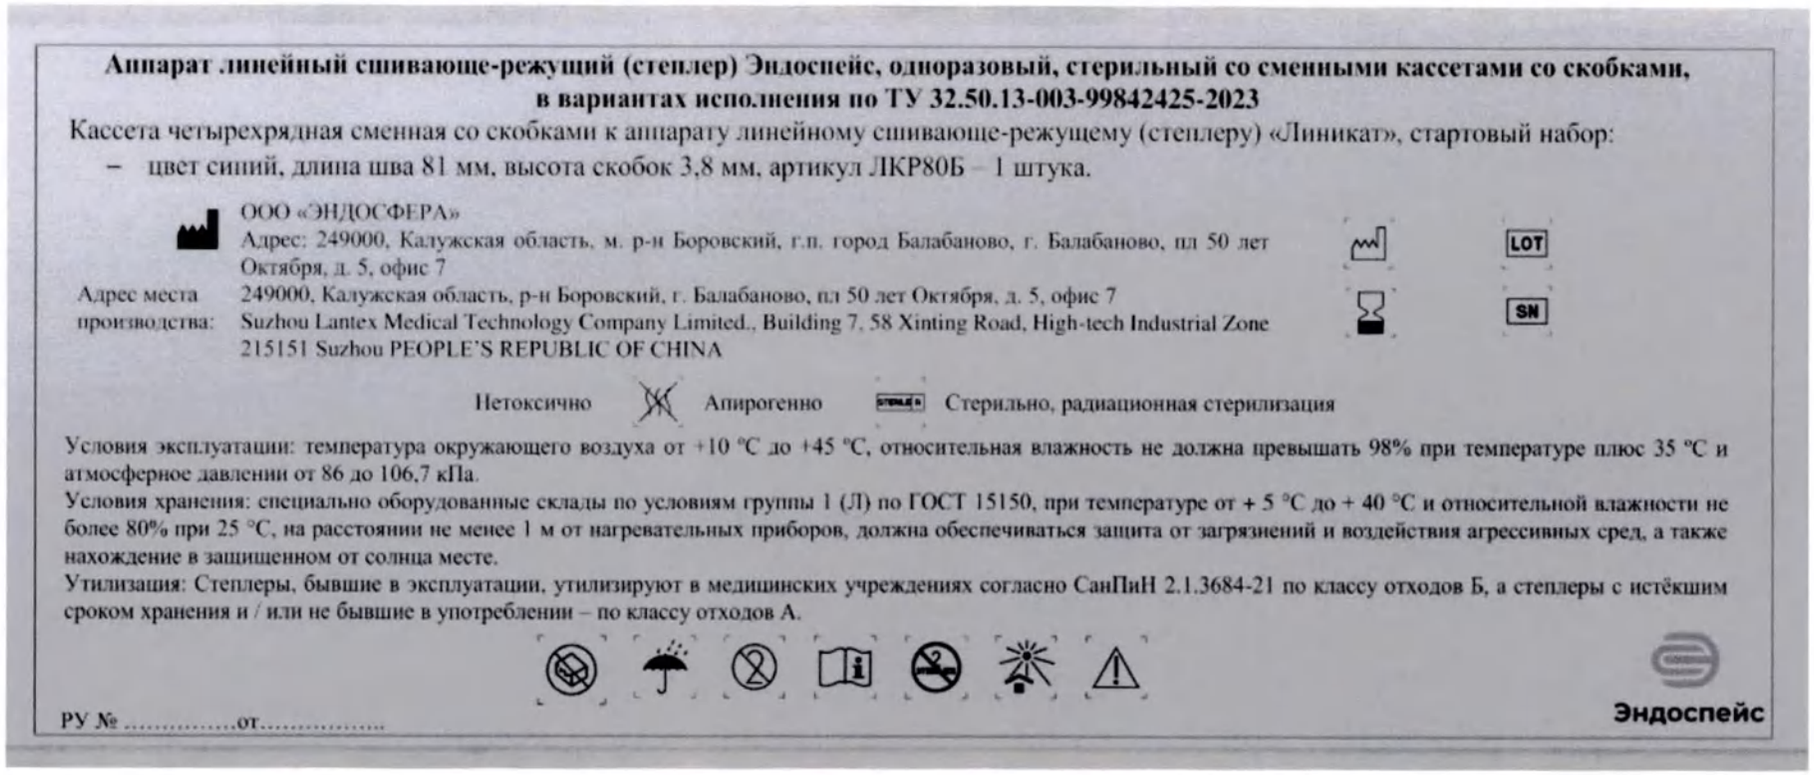

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 118А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 119 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

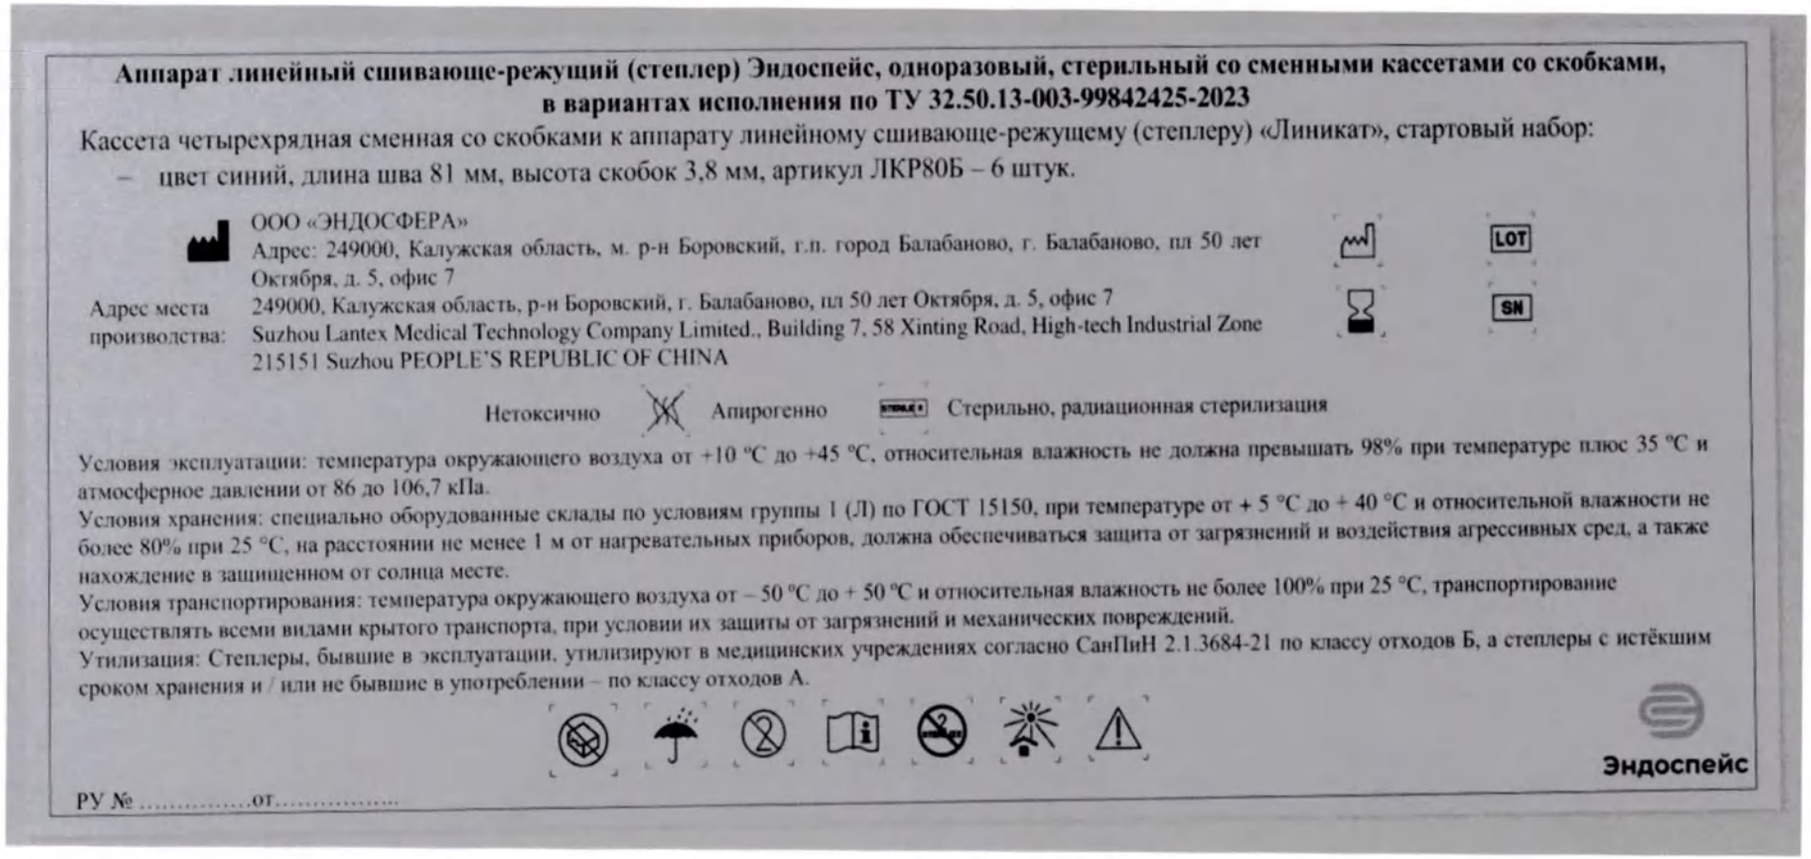

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 119А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 120 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

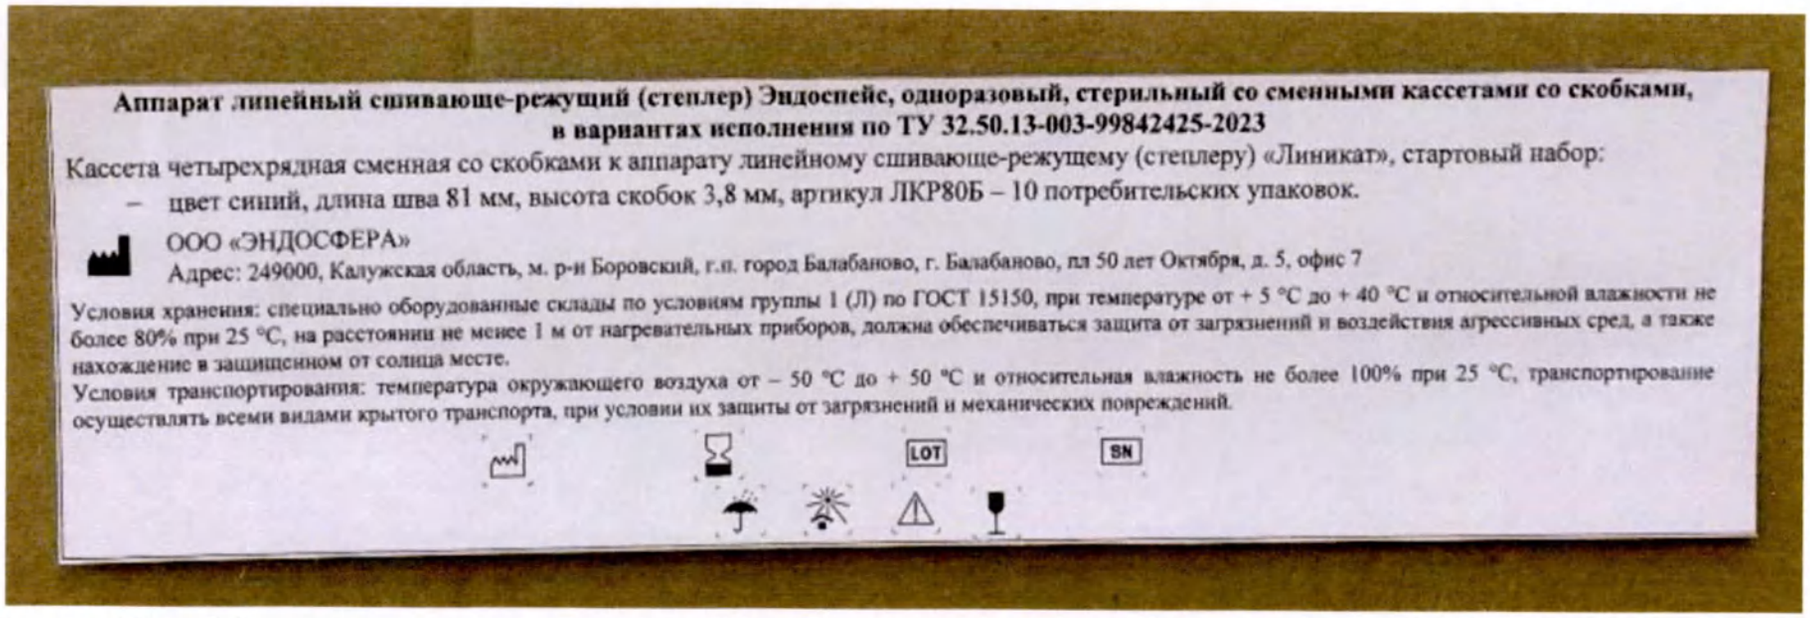

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 120А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:
цвет синий, длина шва 81 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР80Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

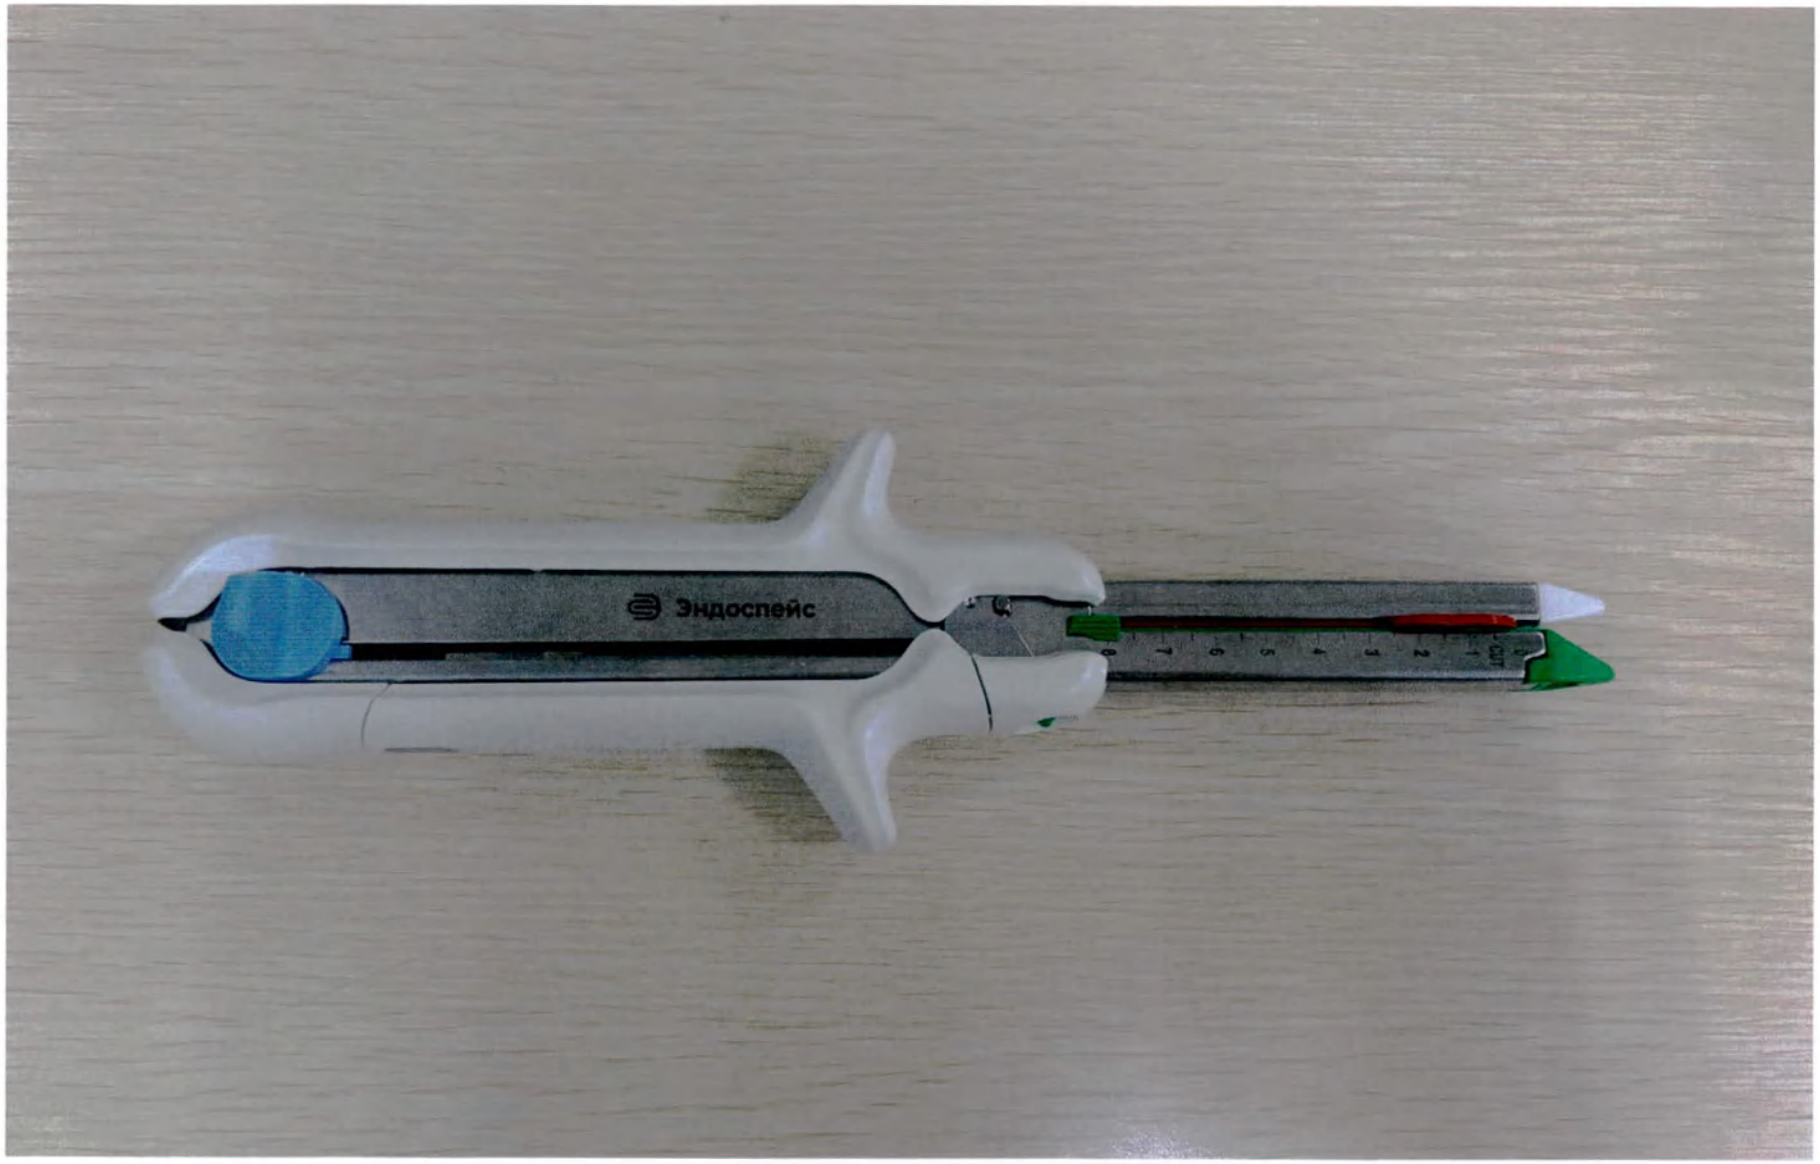

Рисунок 121 – Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 122 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

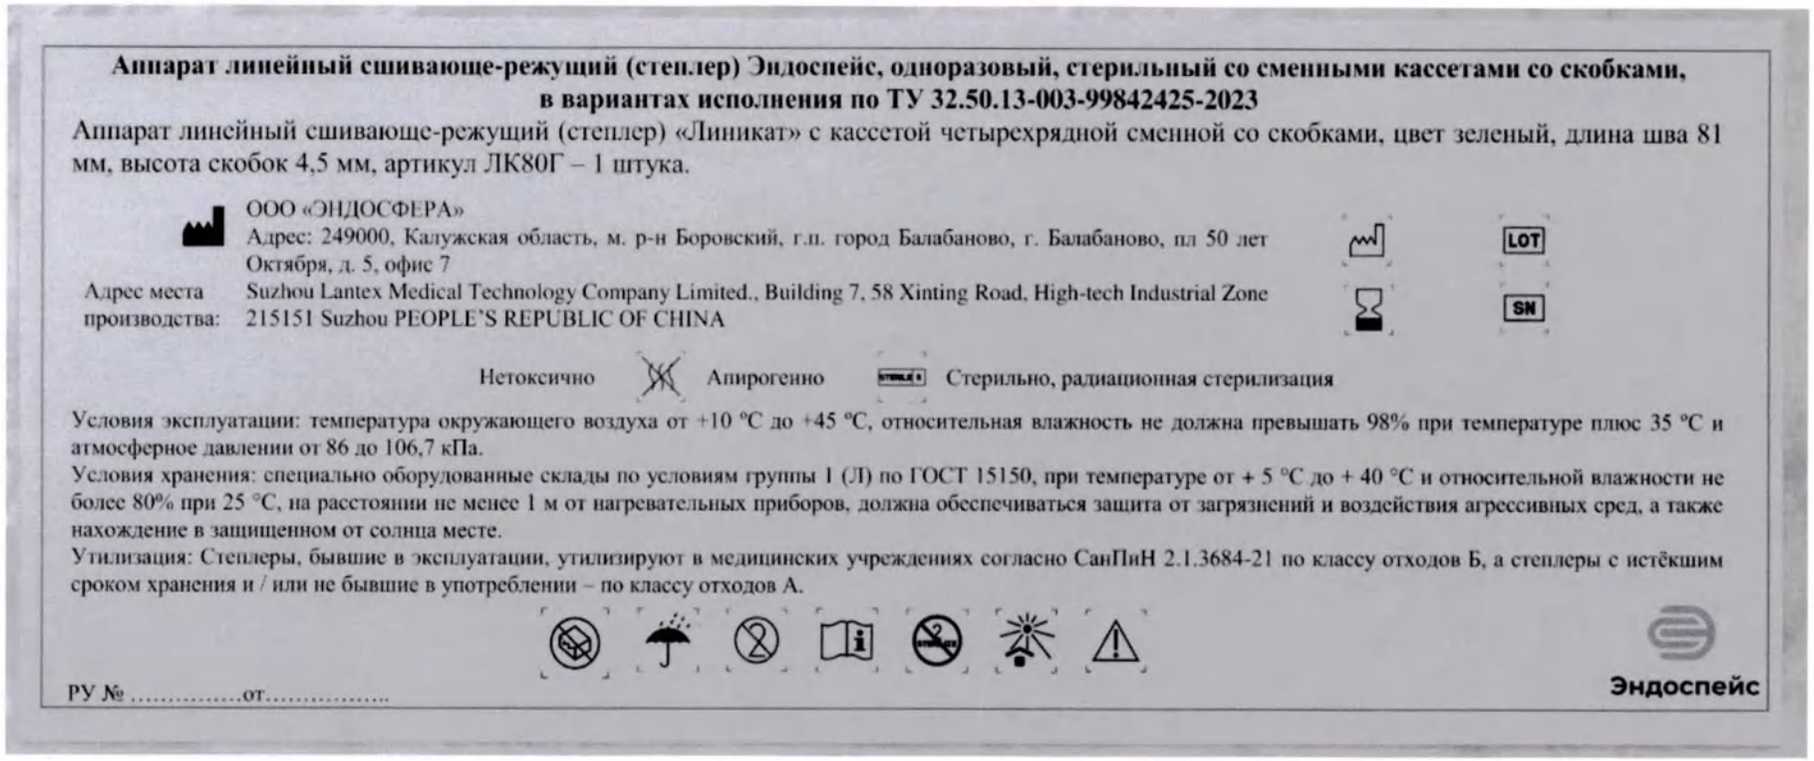

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 122А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

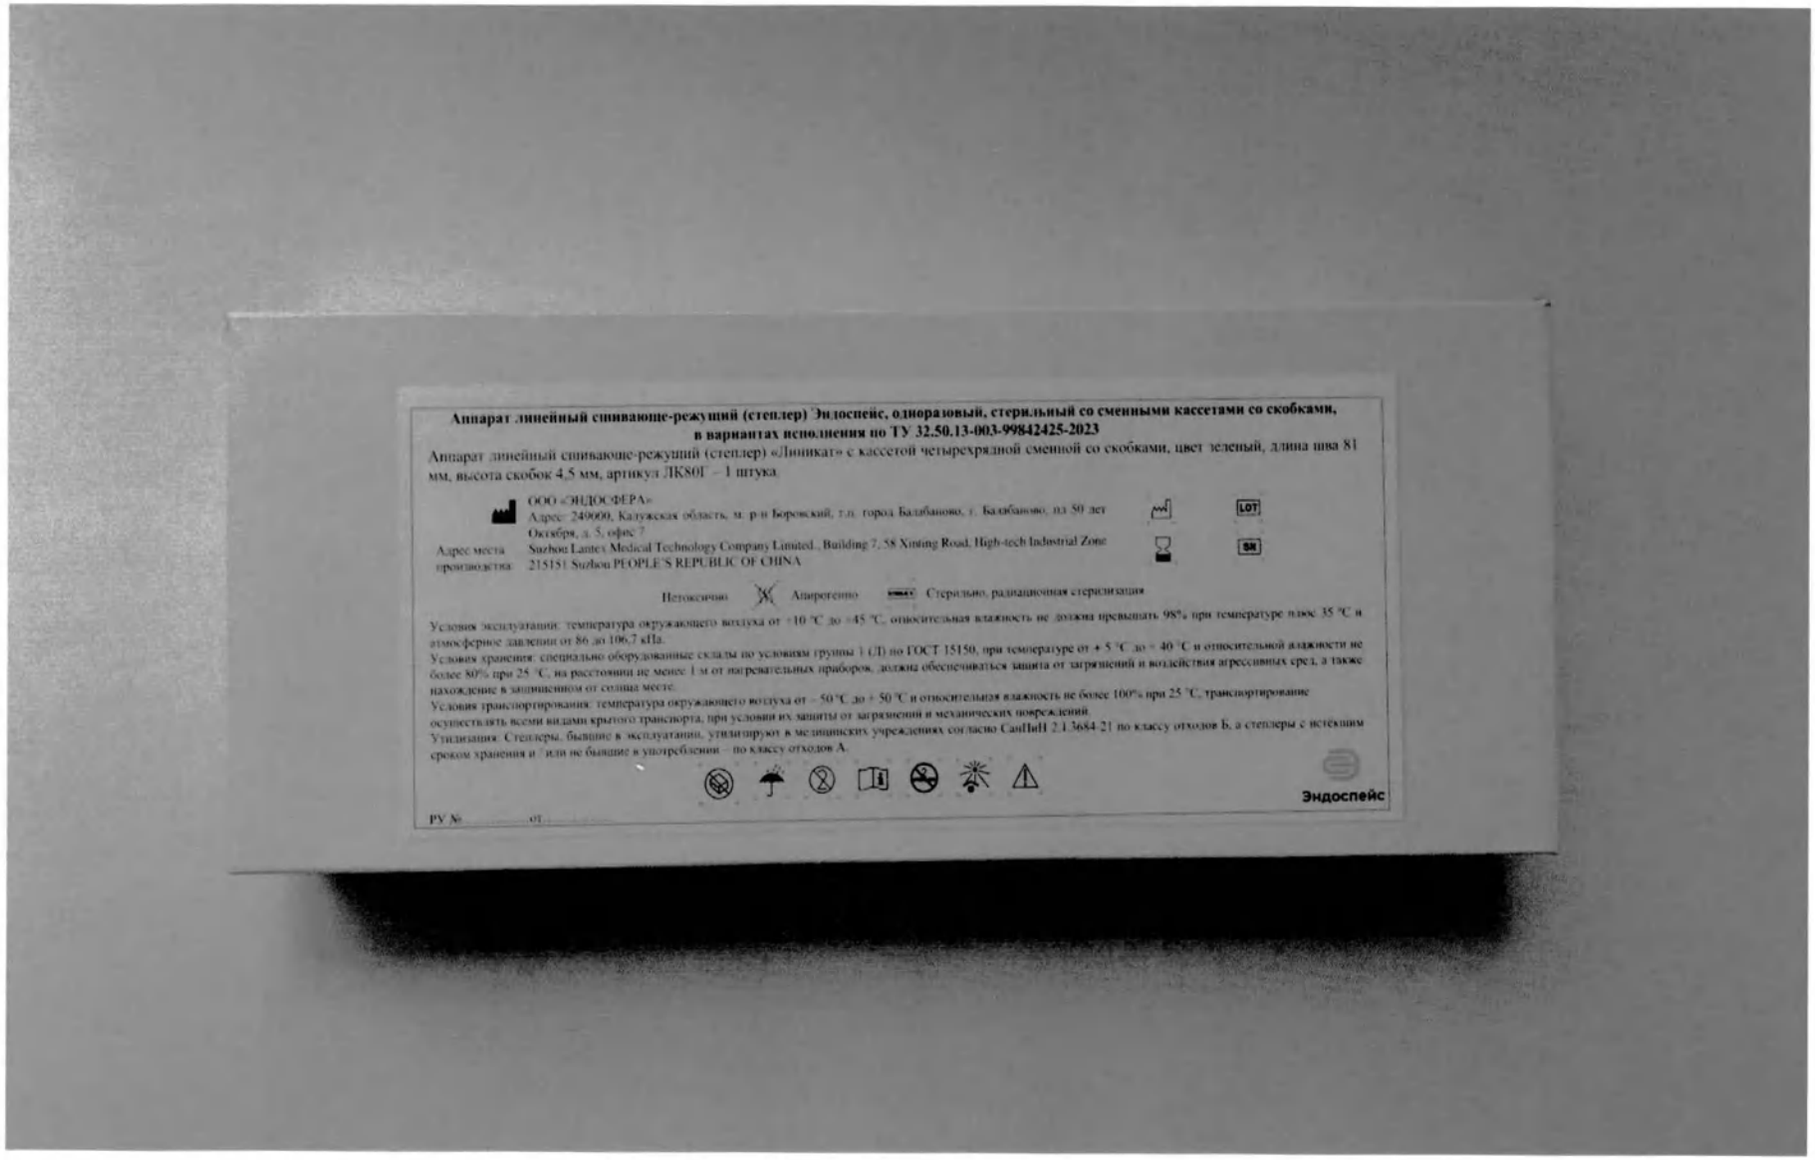

Рисунок 123 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 123А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

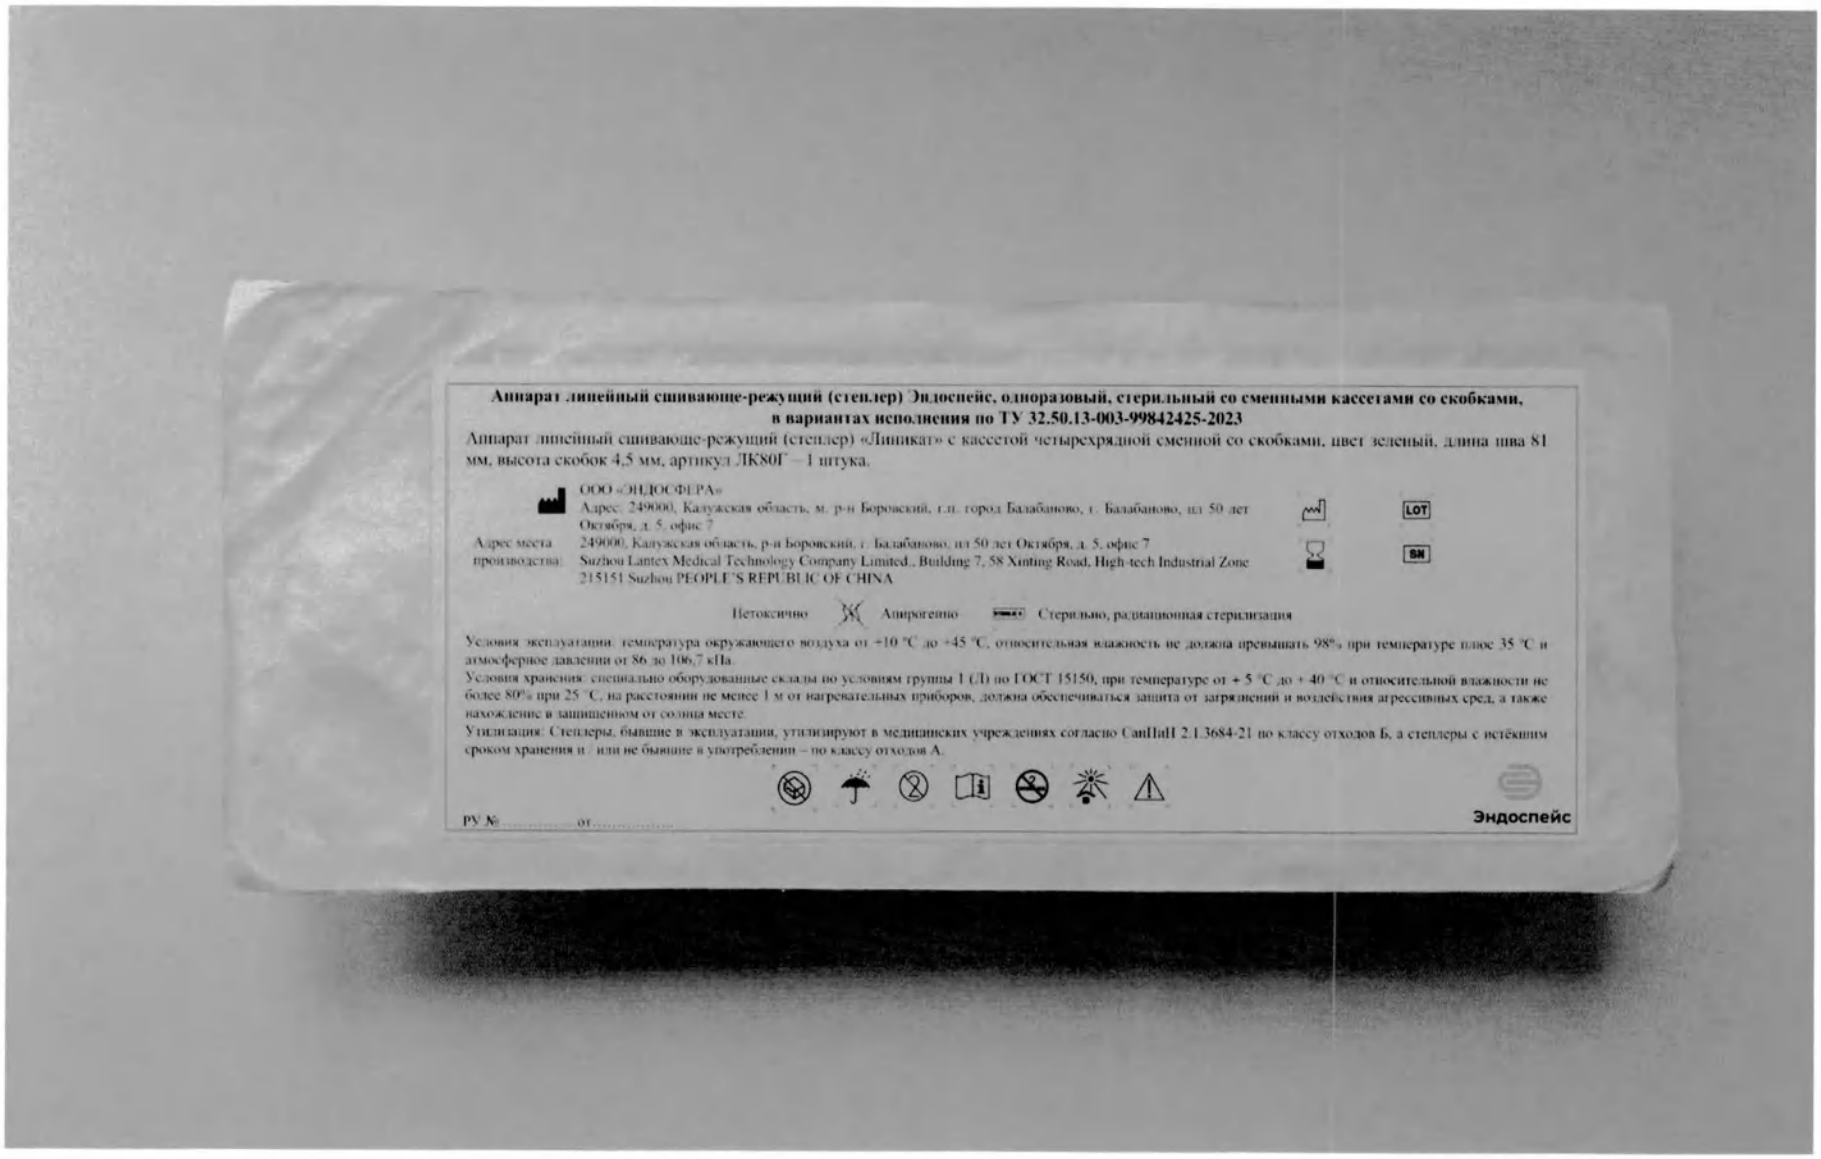

Рисунок 124 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

Рисунок 124А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

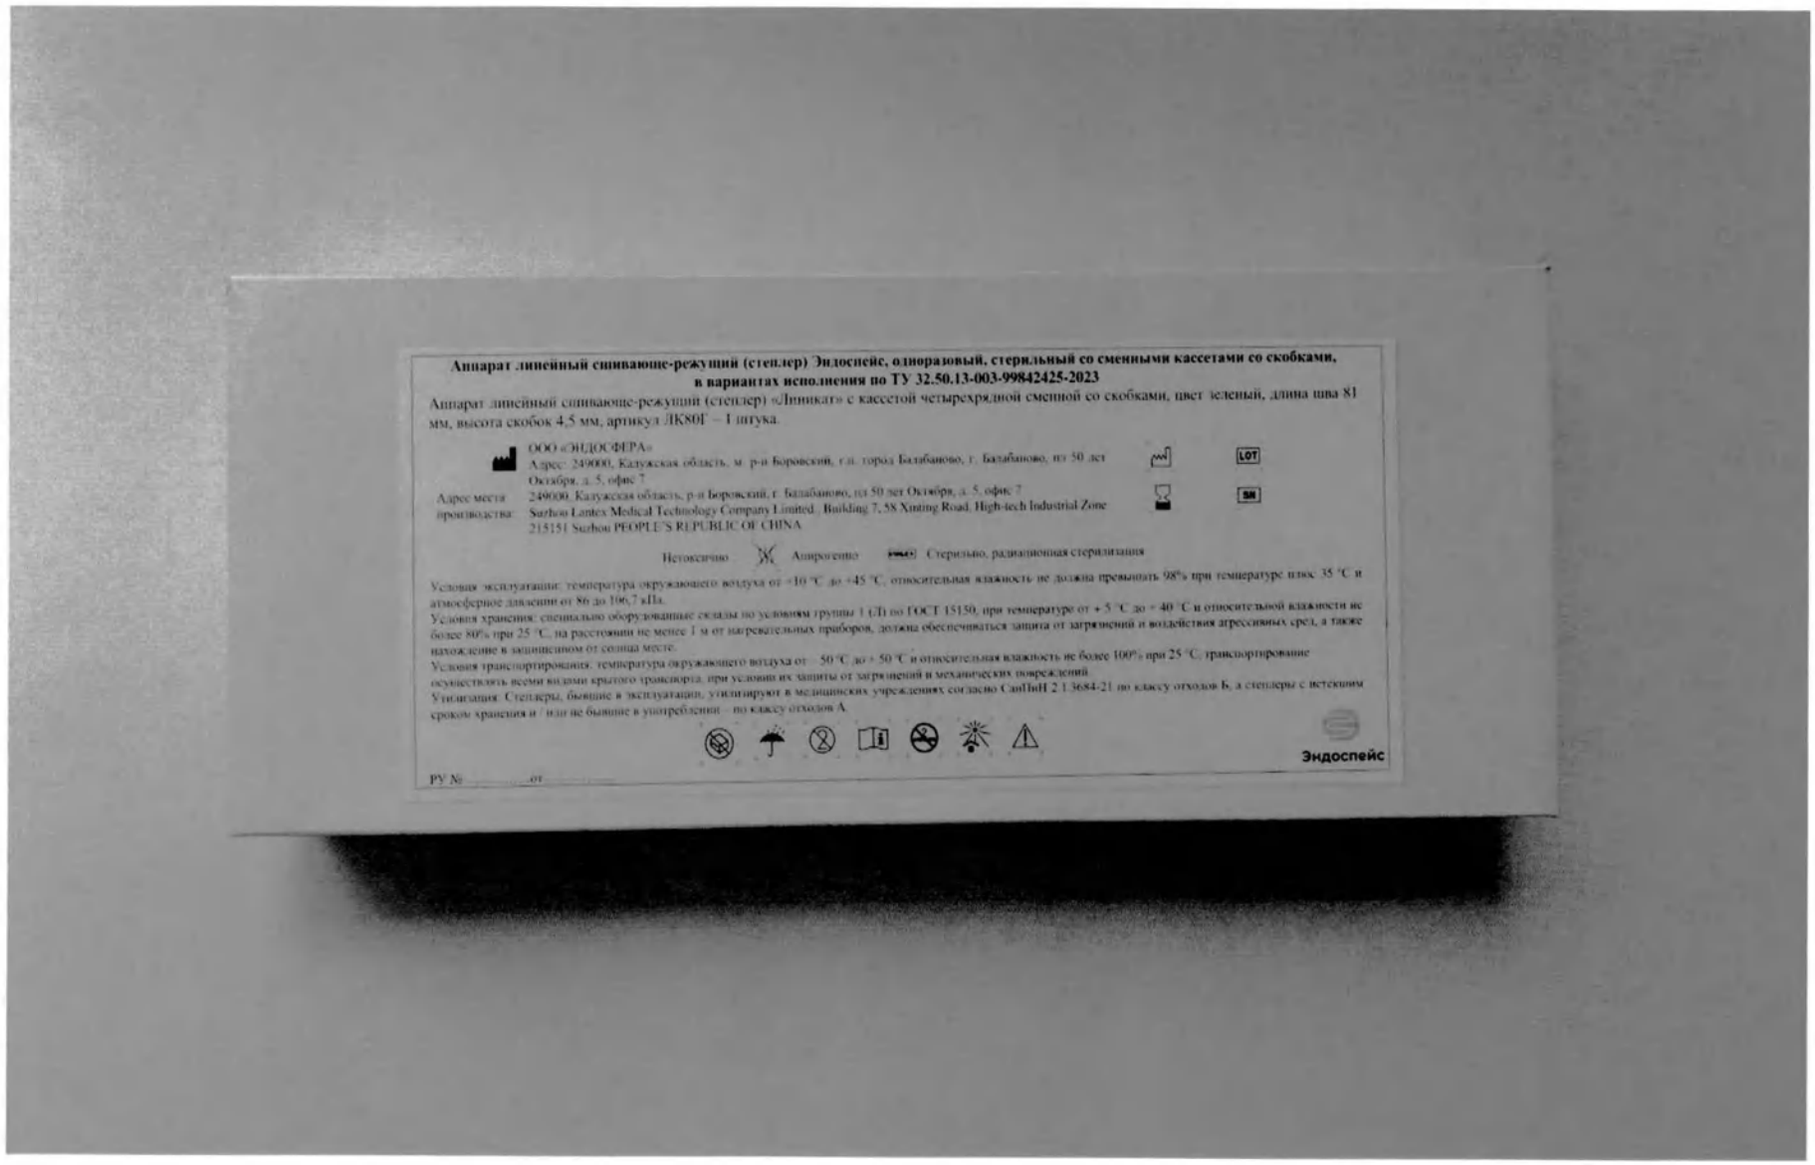

Рисунок 125 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 125А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 126 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

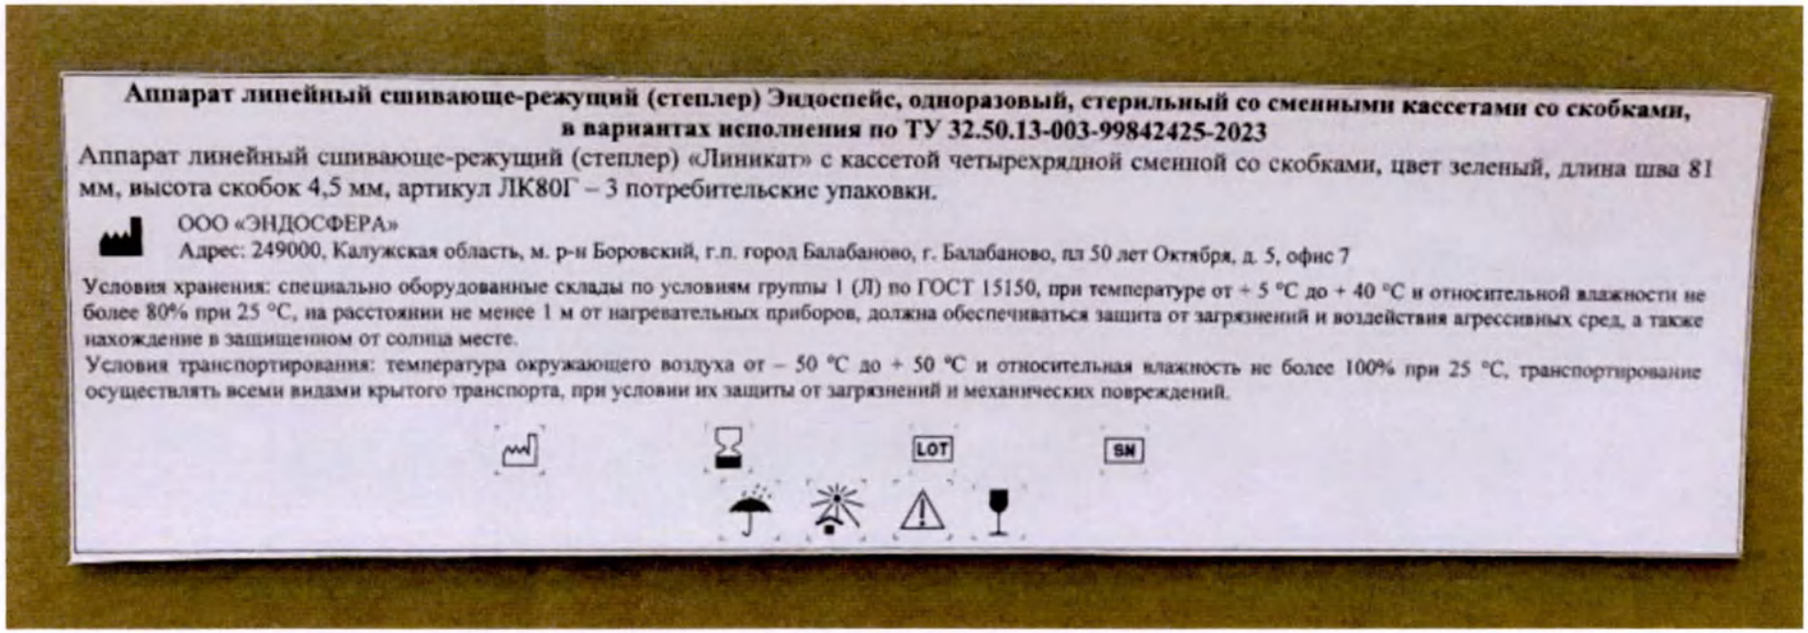

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 126А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

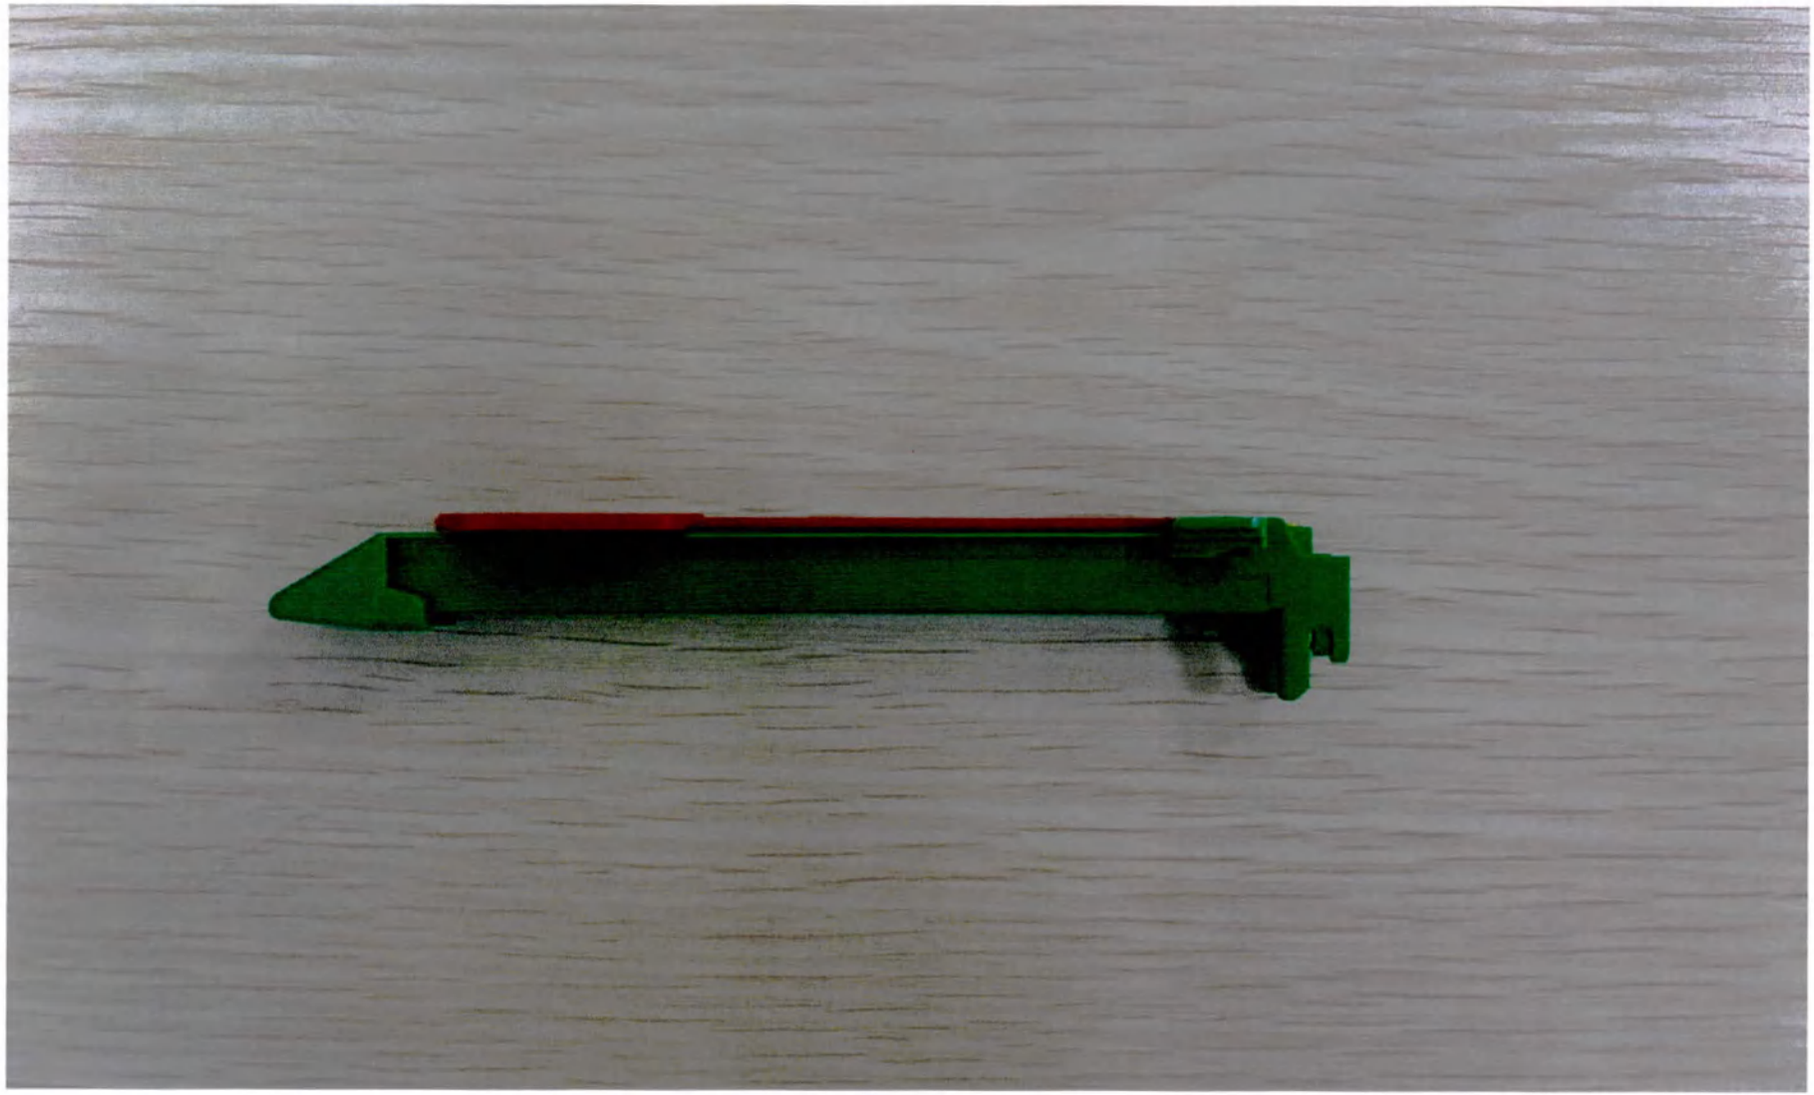

Рисунок 127 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

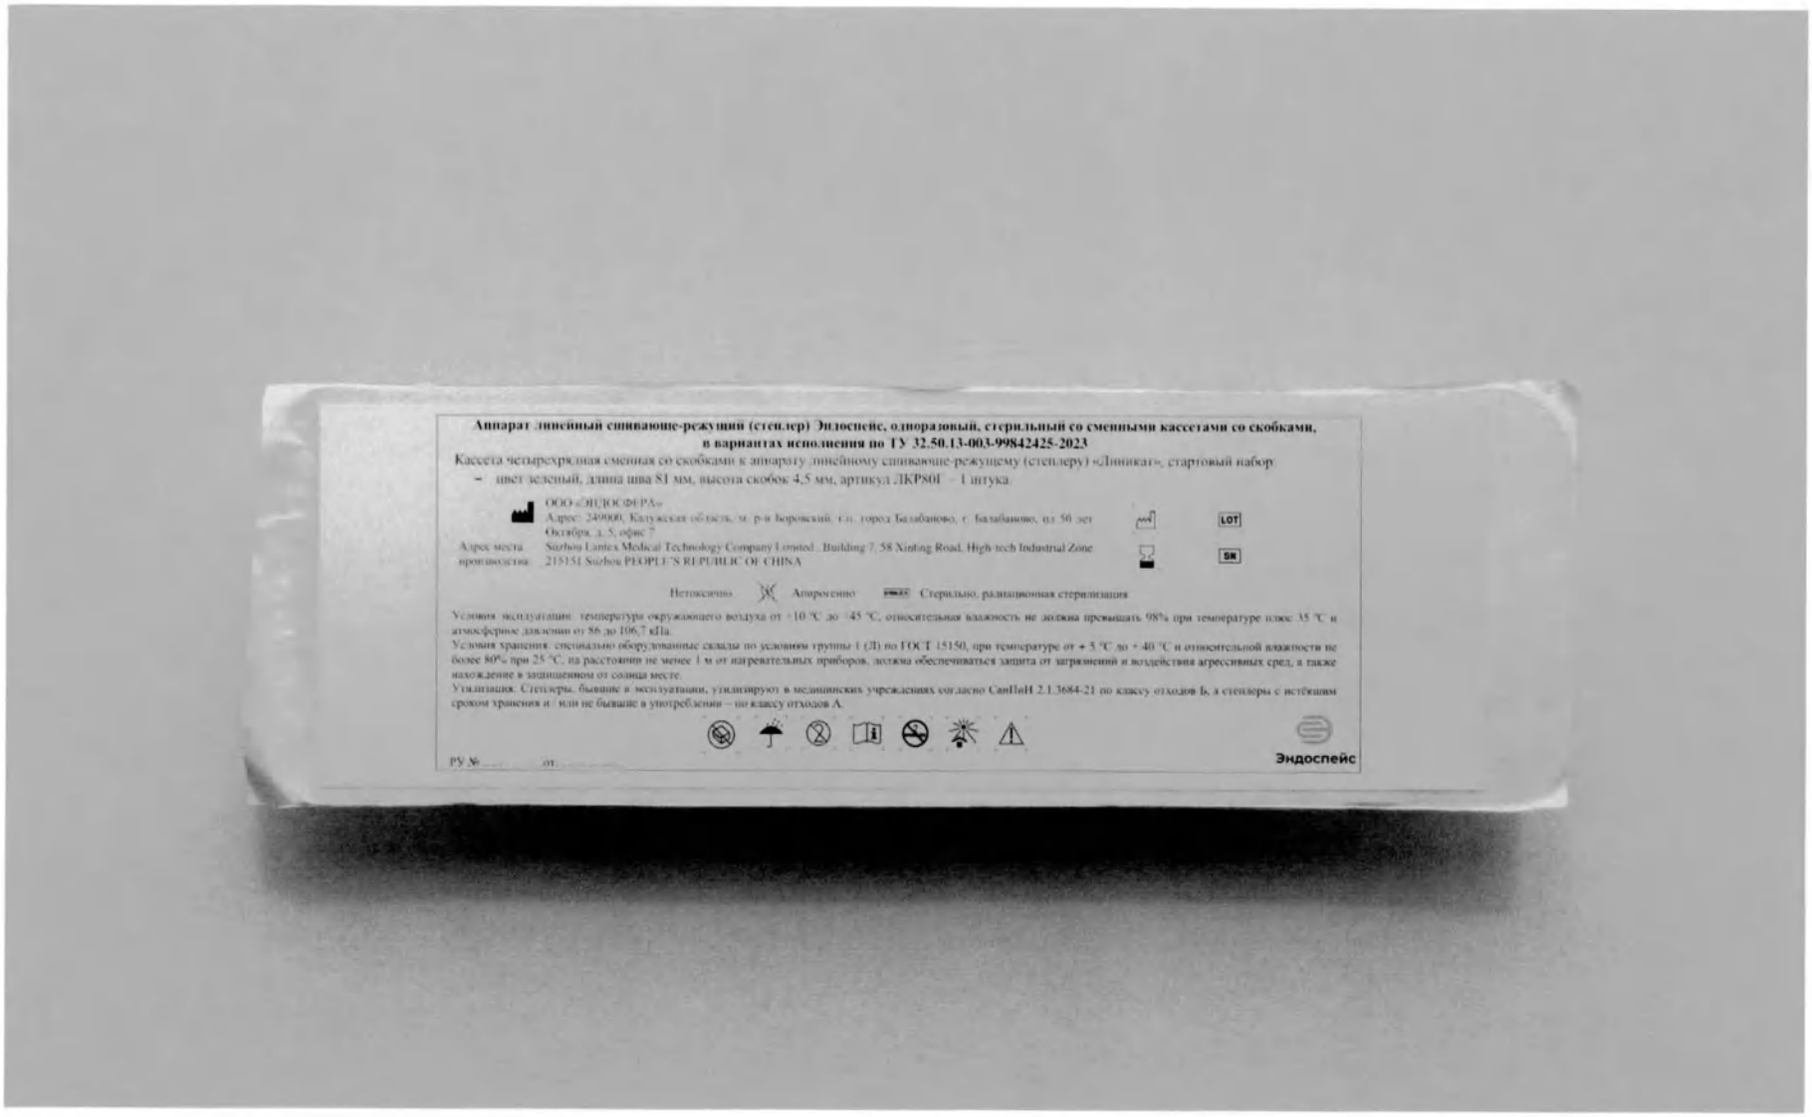

Рисунок 128 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

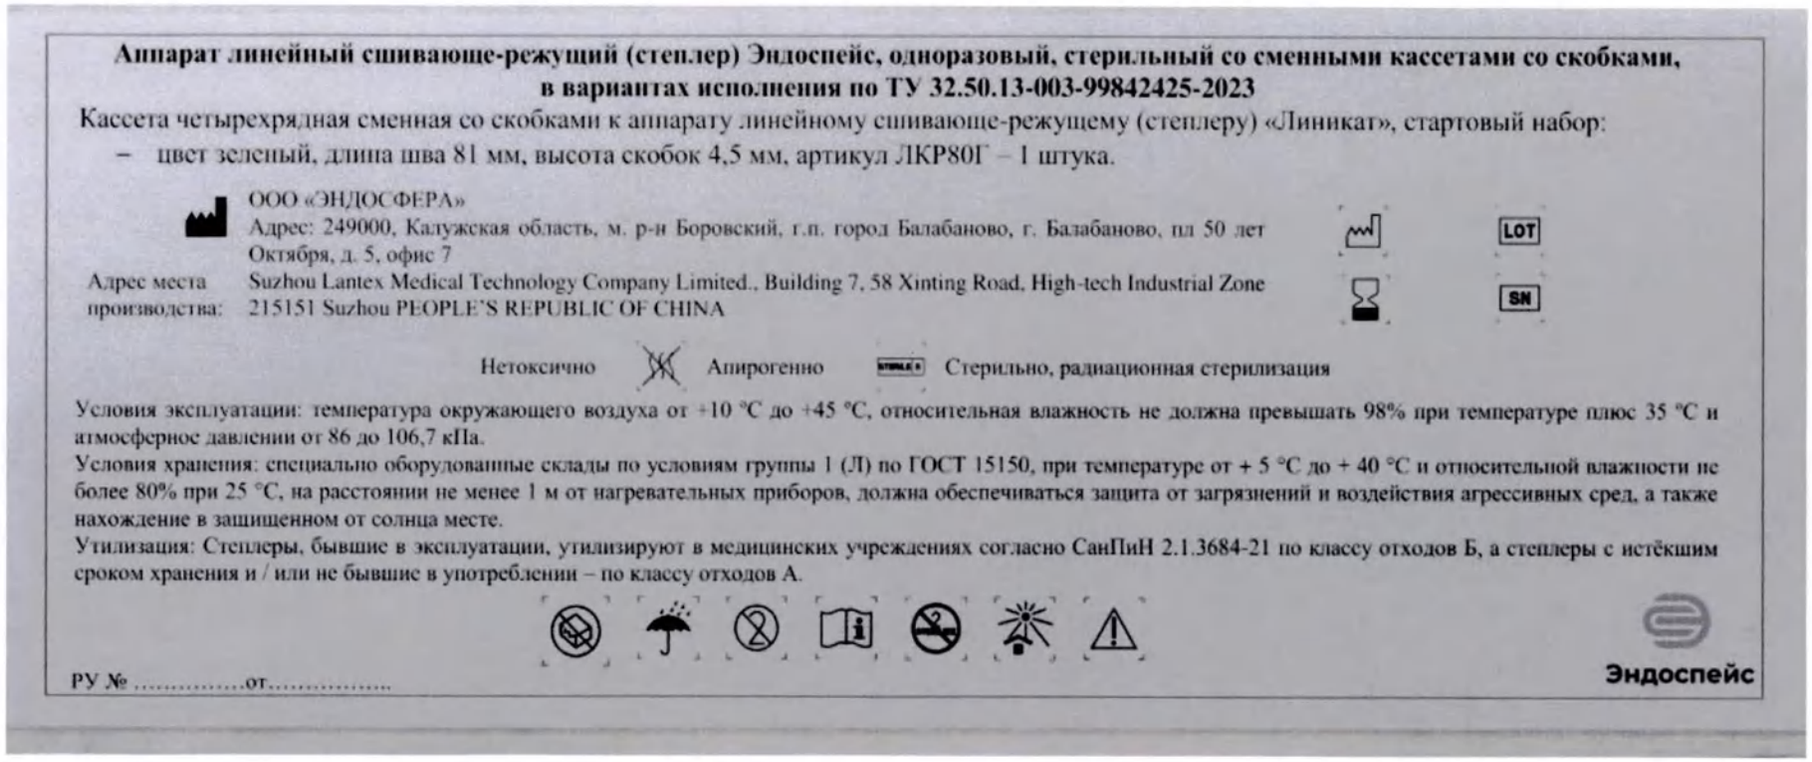

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 128А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

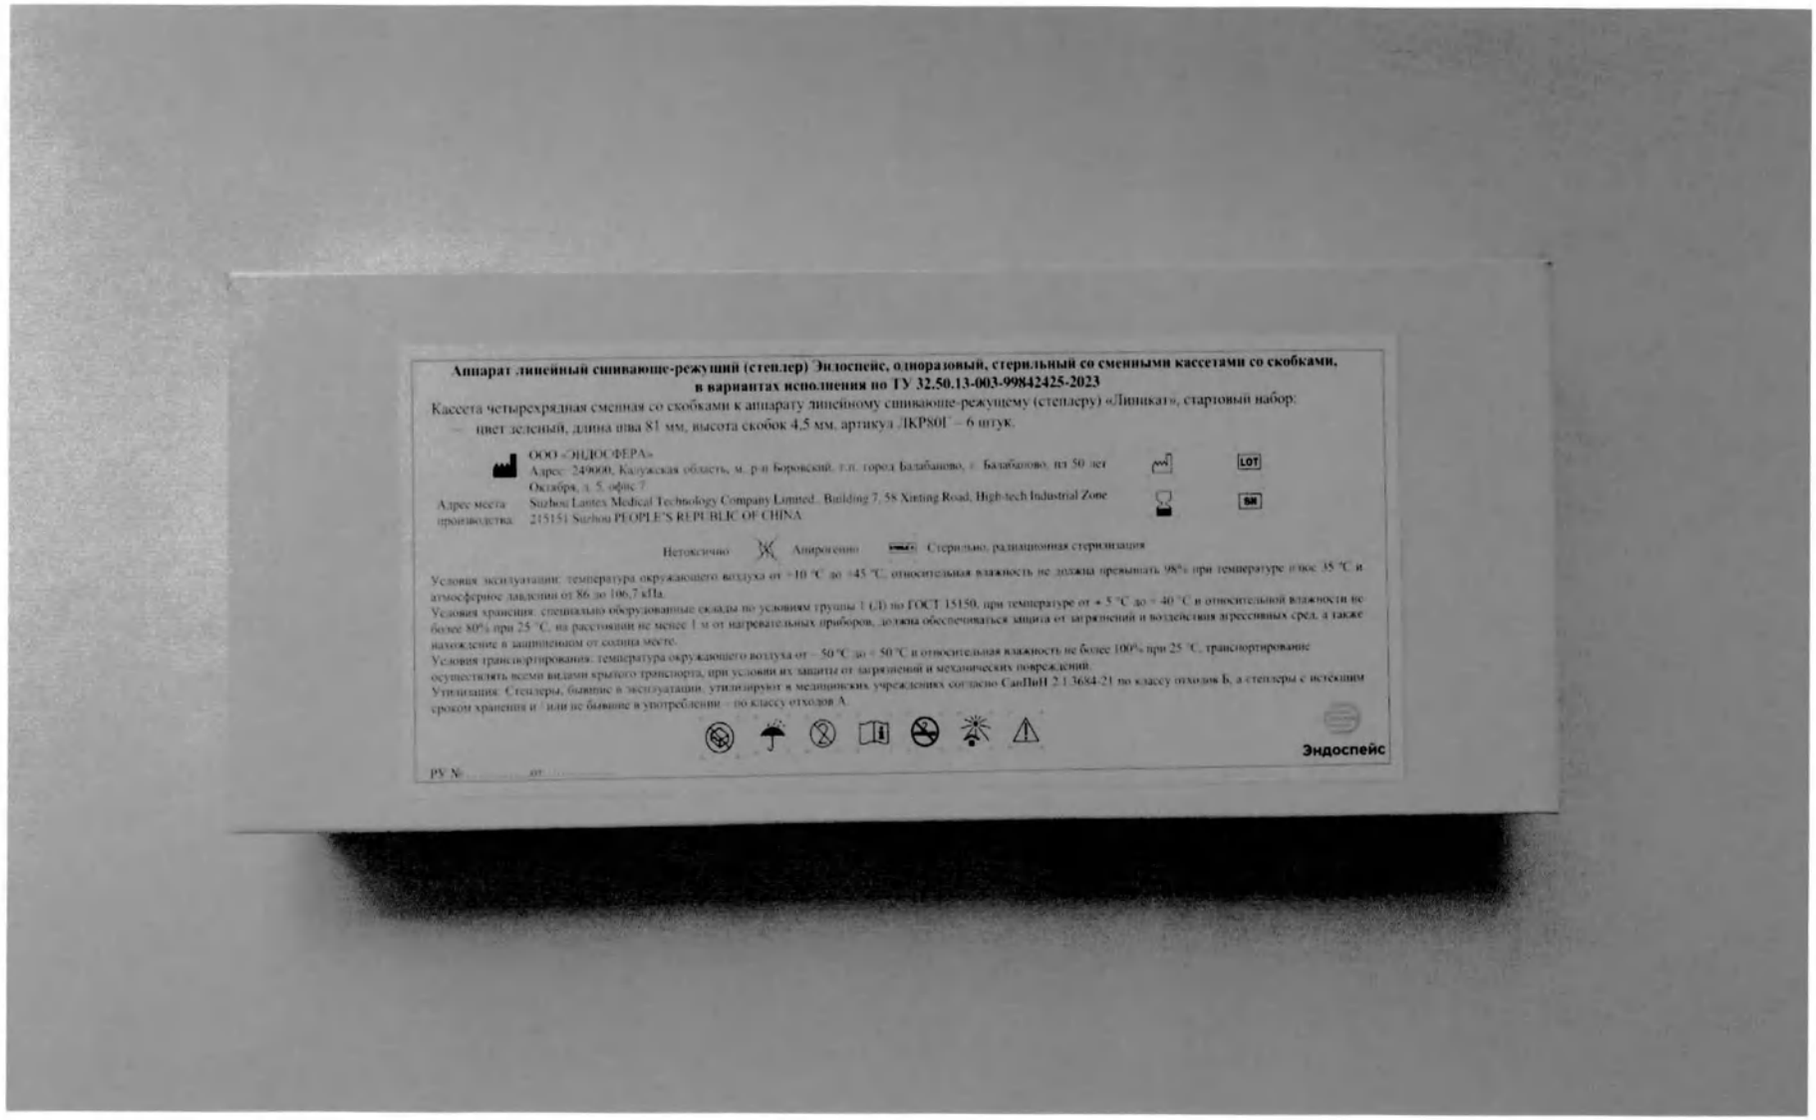

Рисунок 129 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

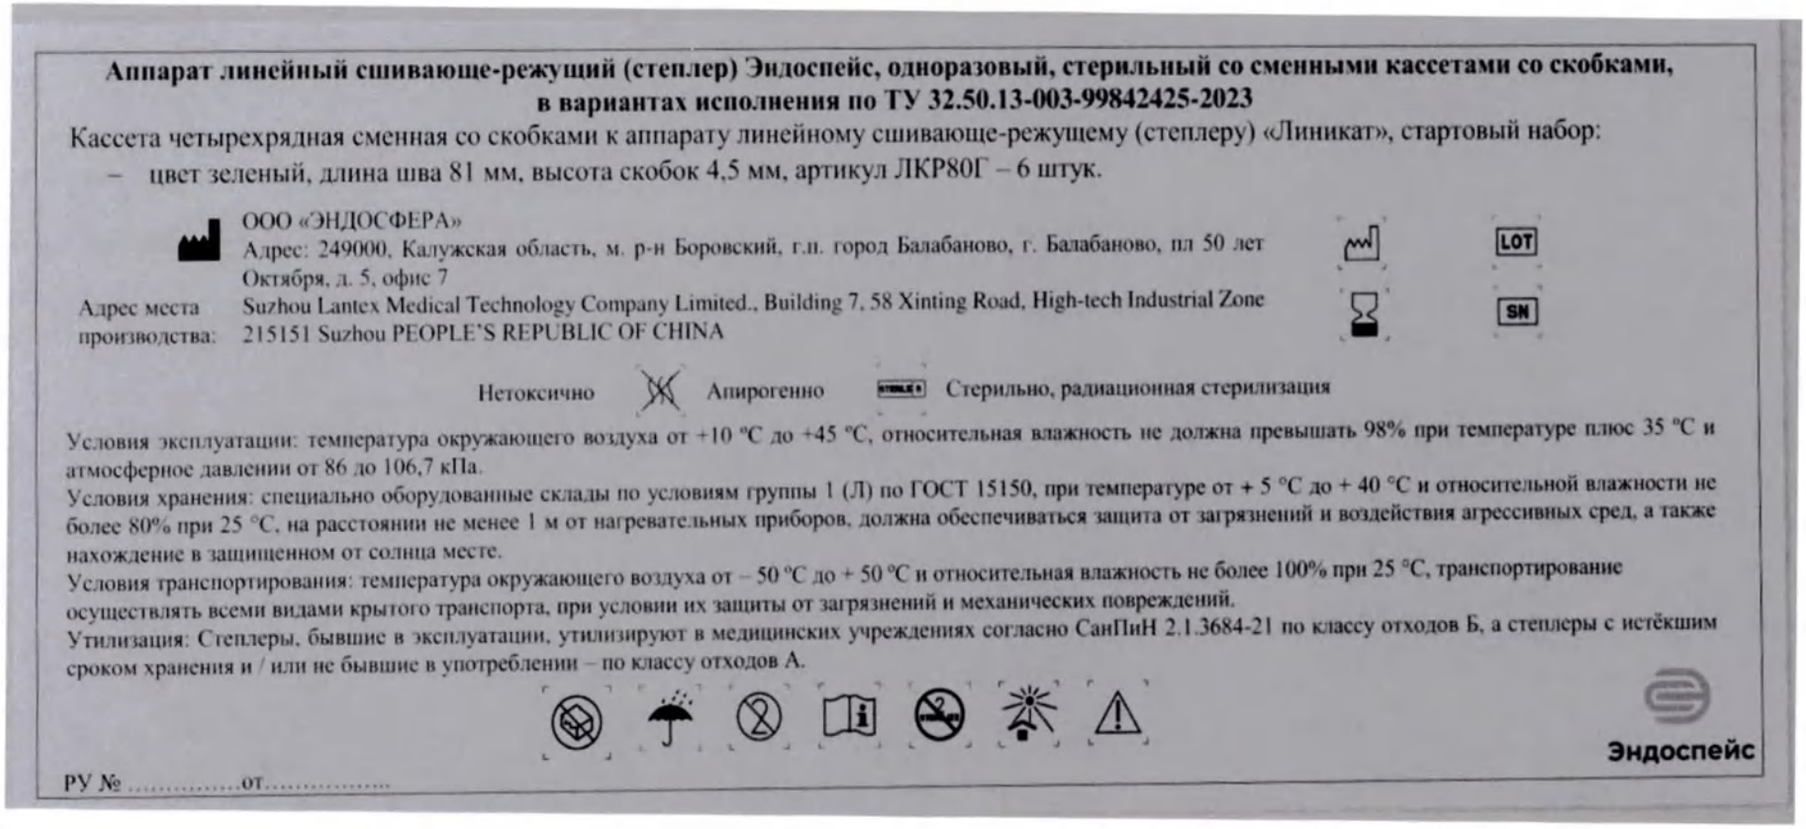

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 129А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 130 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

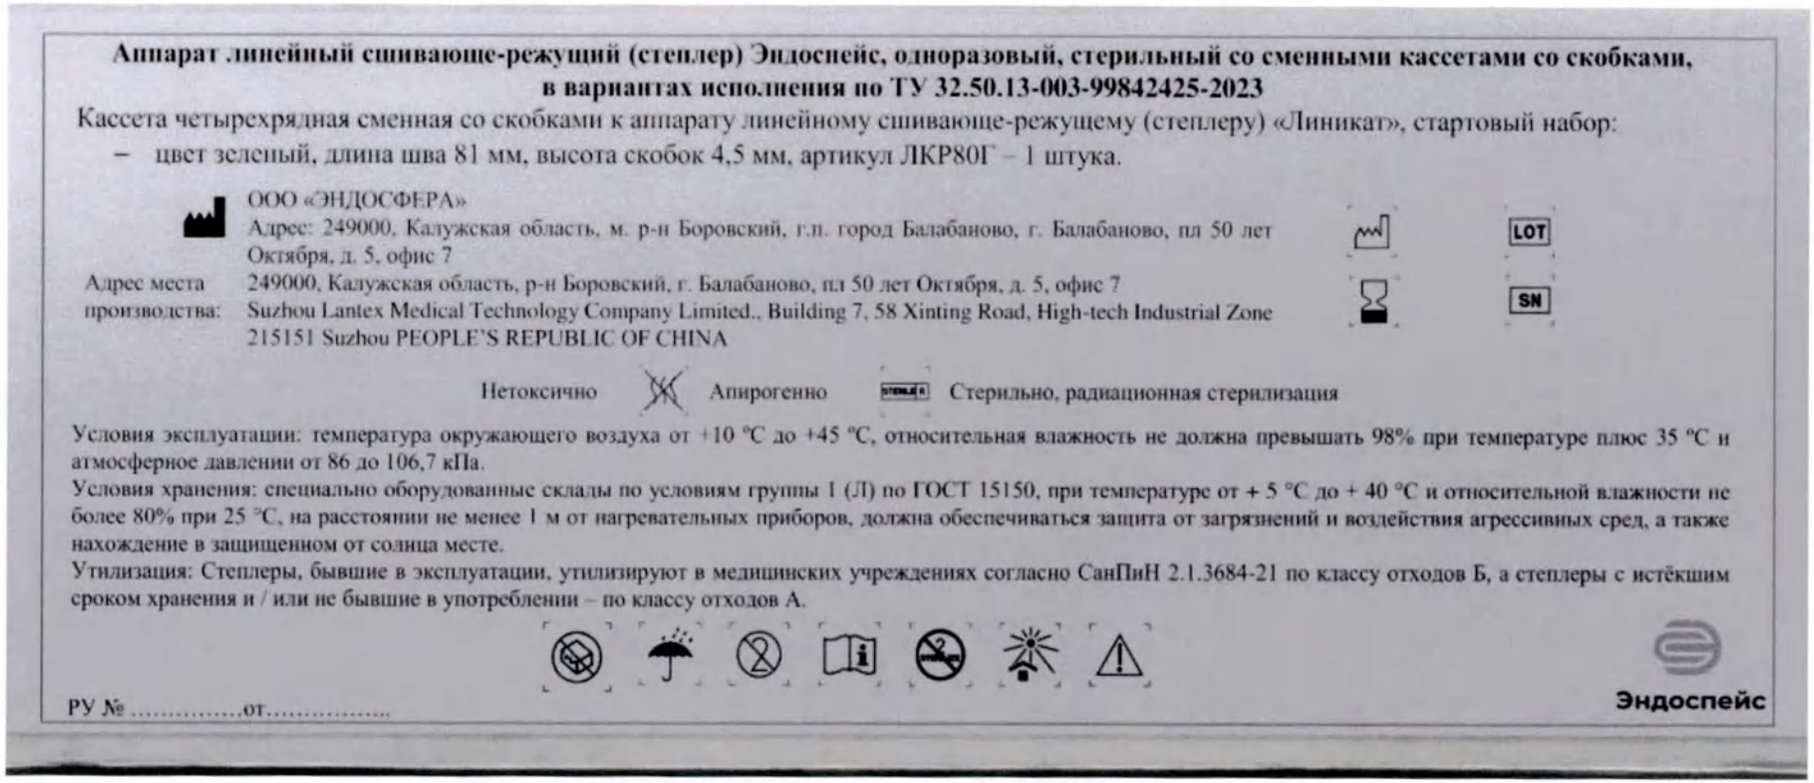

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 130А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

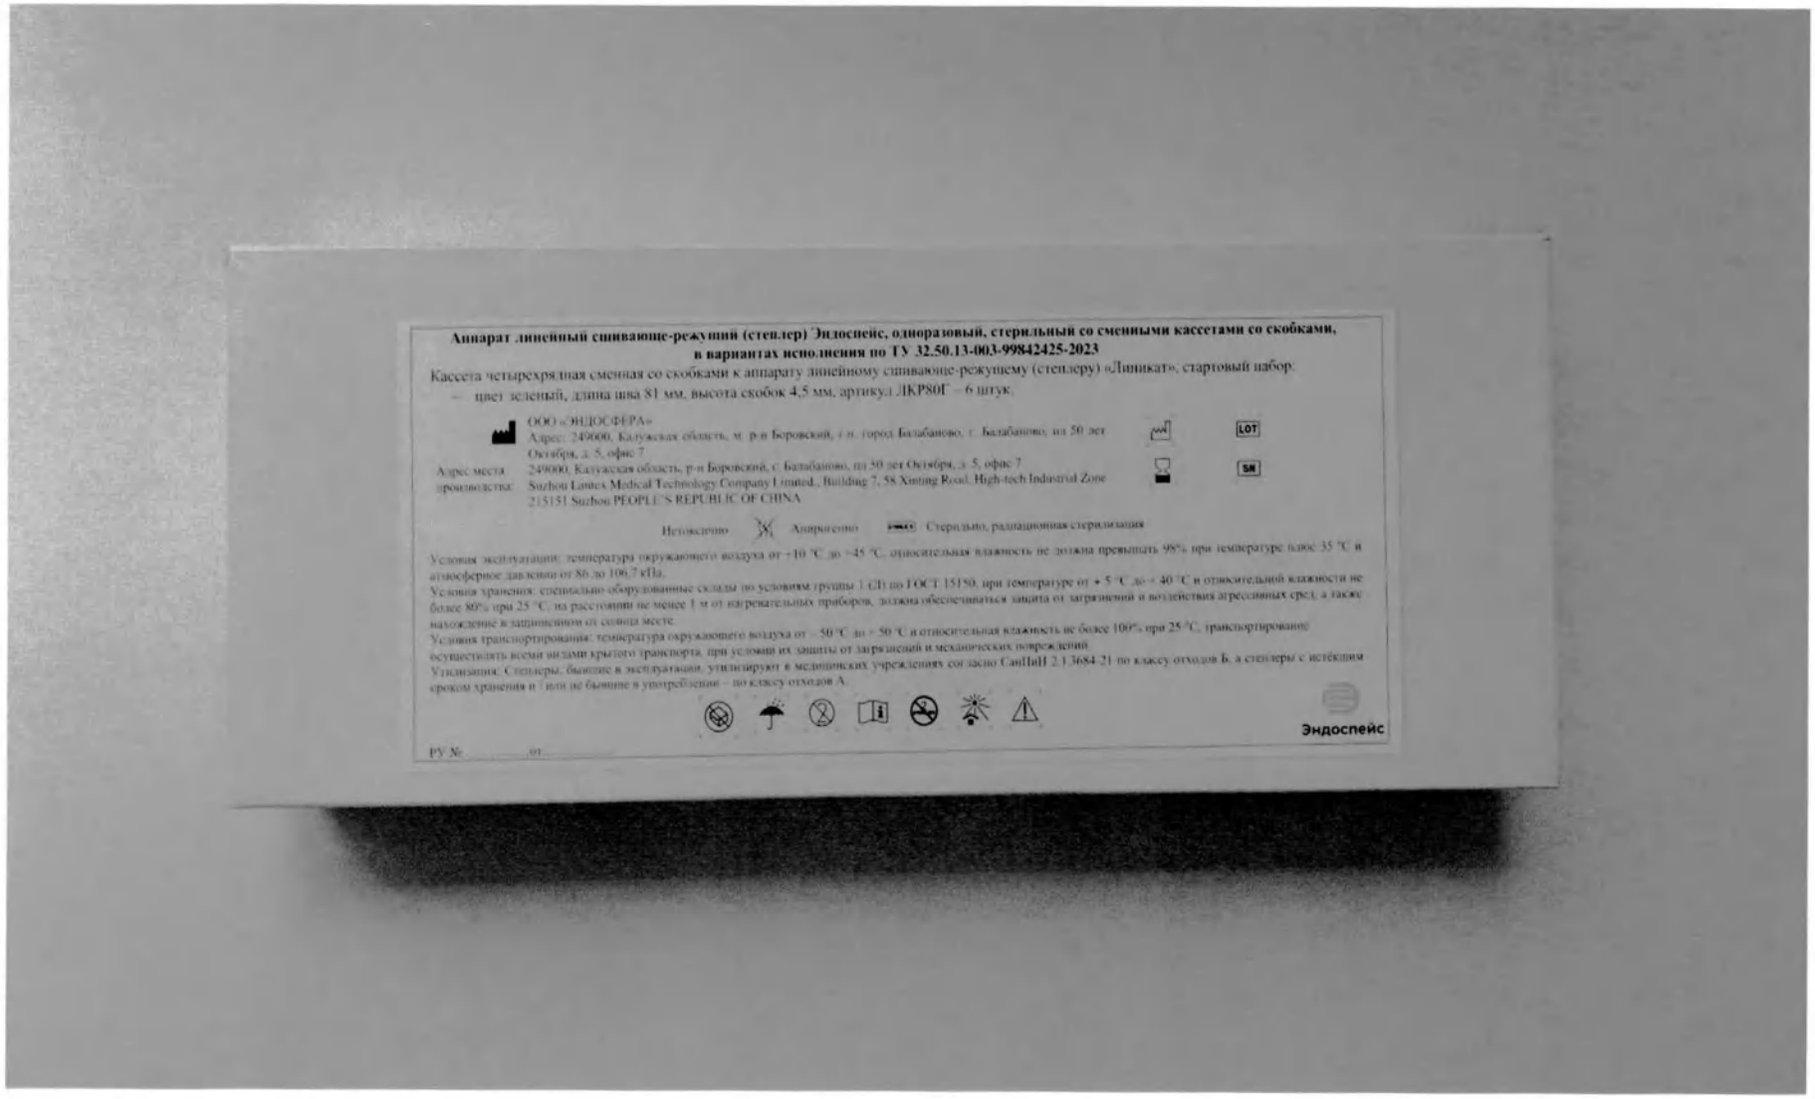

Рисунок 131 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

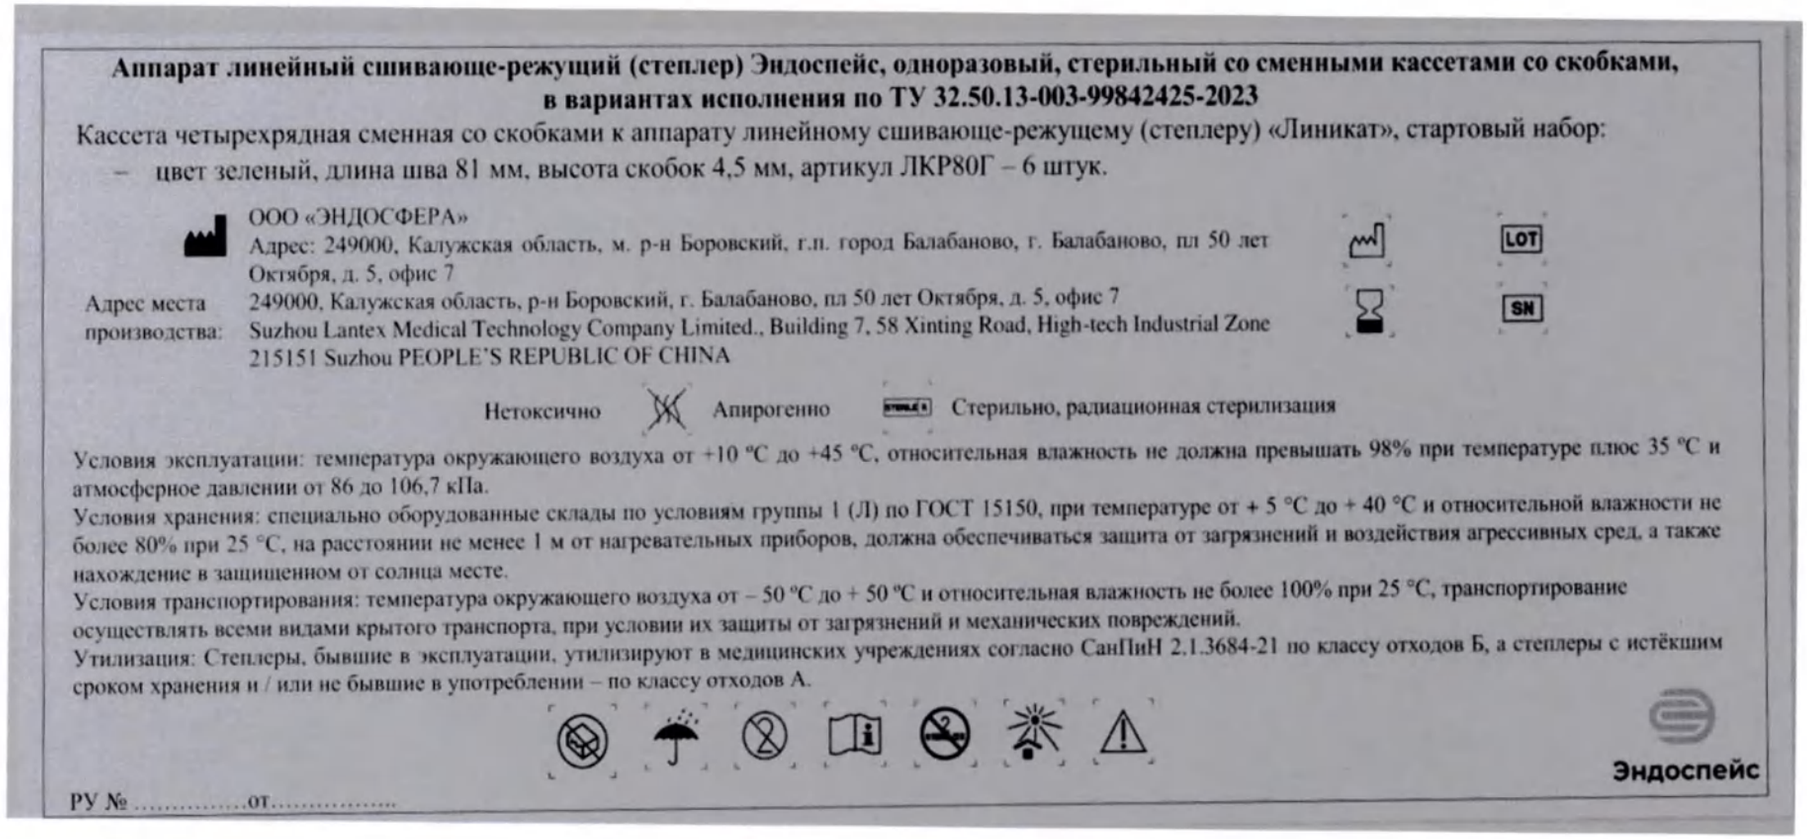

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 131А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 132 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

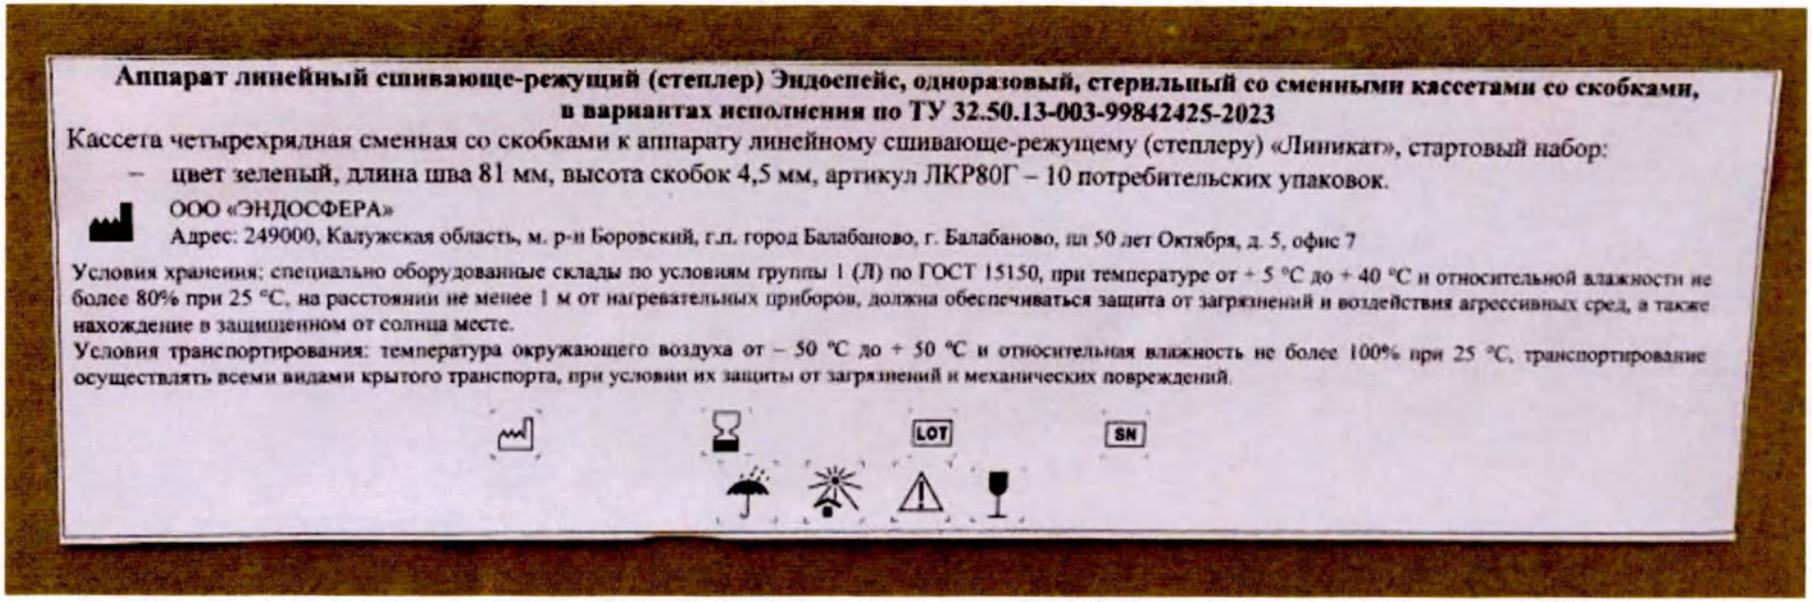

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 132А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:
цвет зеленый, длина шва 81 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР80Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

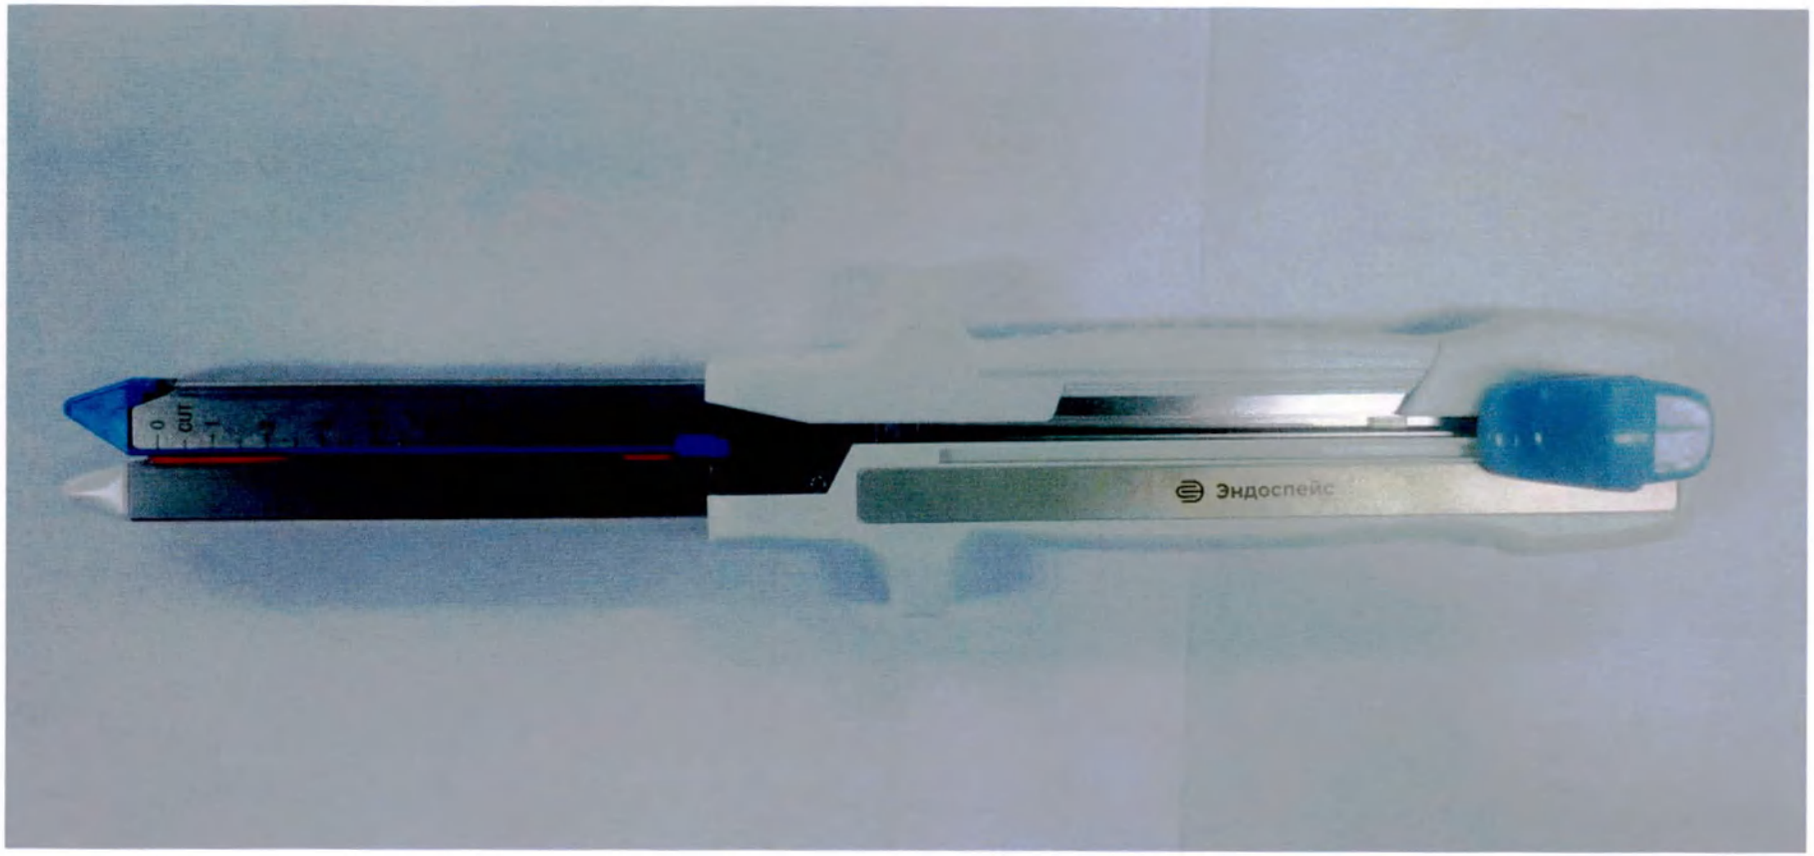

Рисунок 133 – Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 134 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 134А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

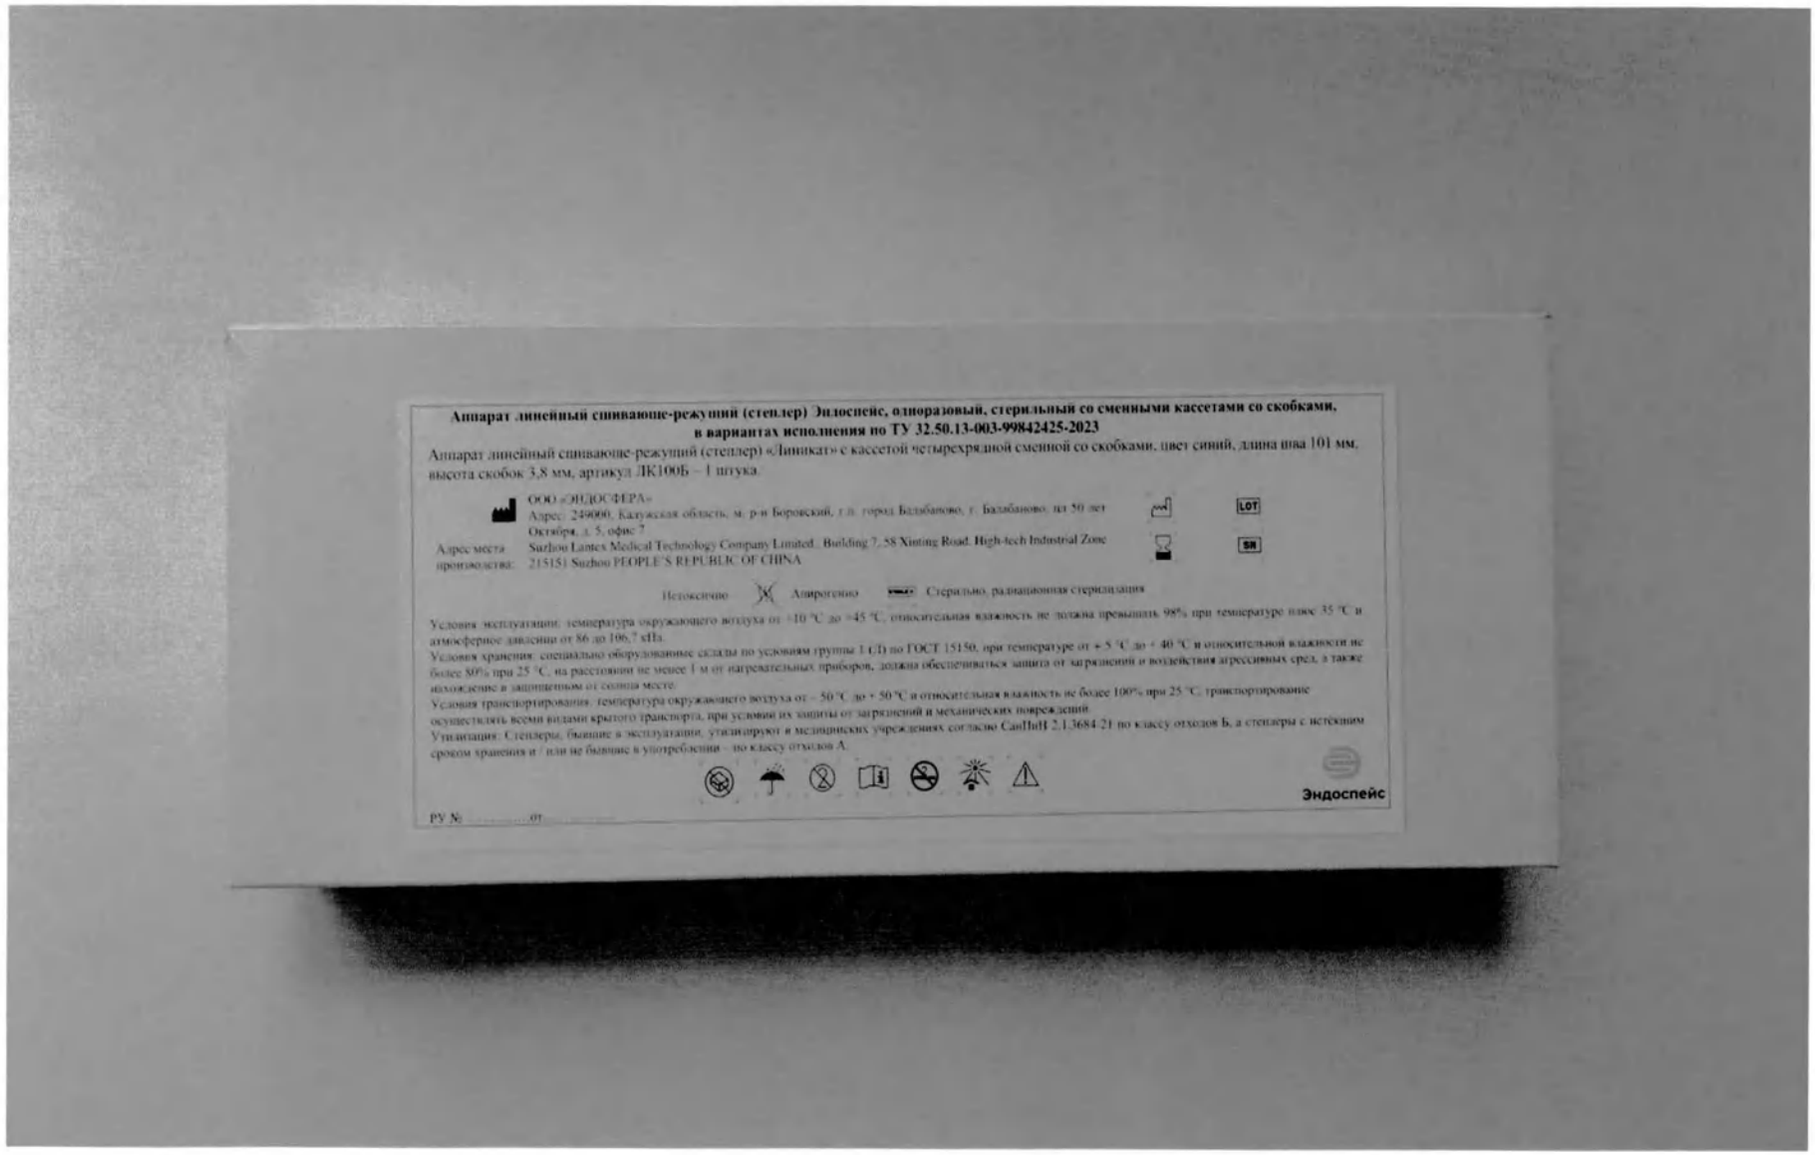

Рисунок 135 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

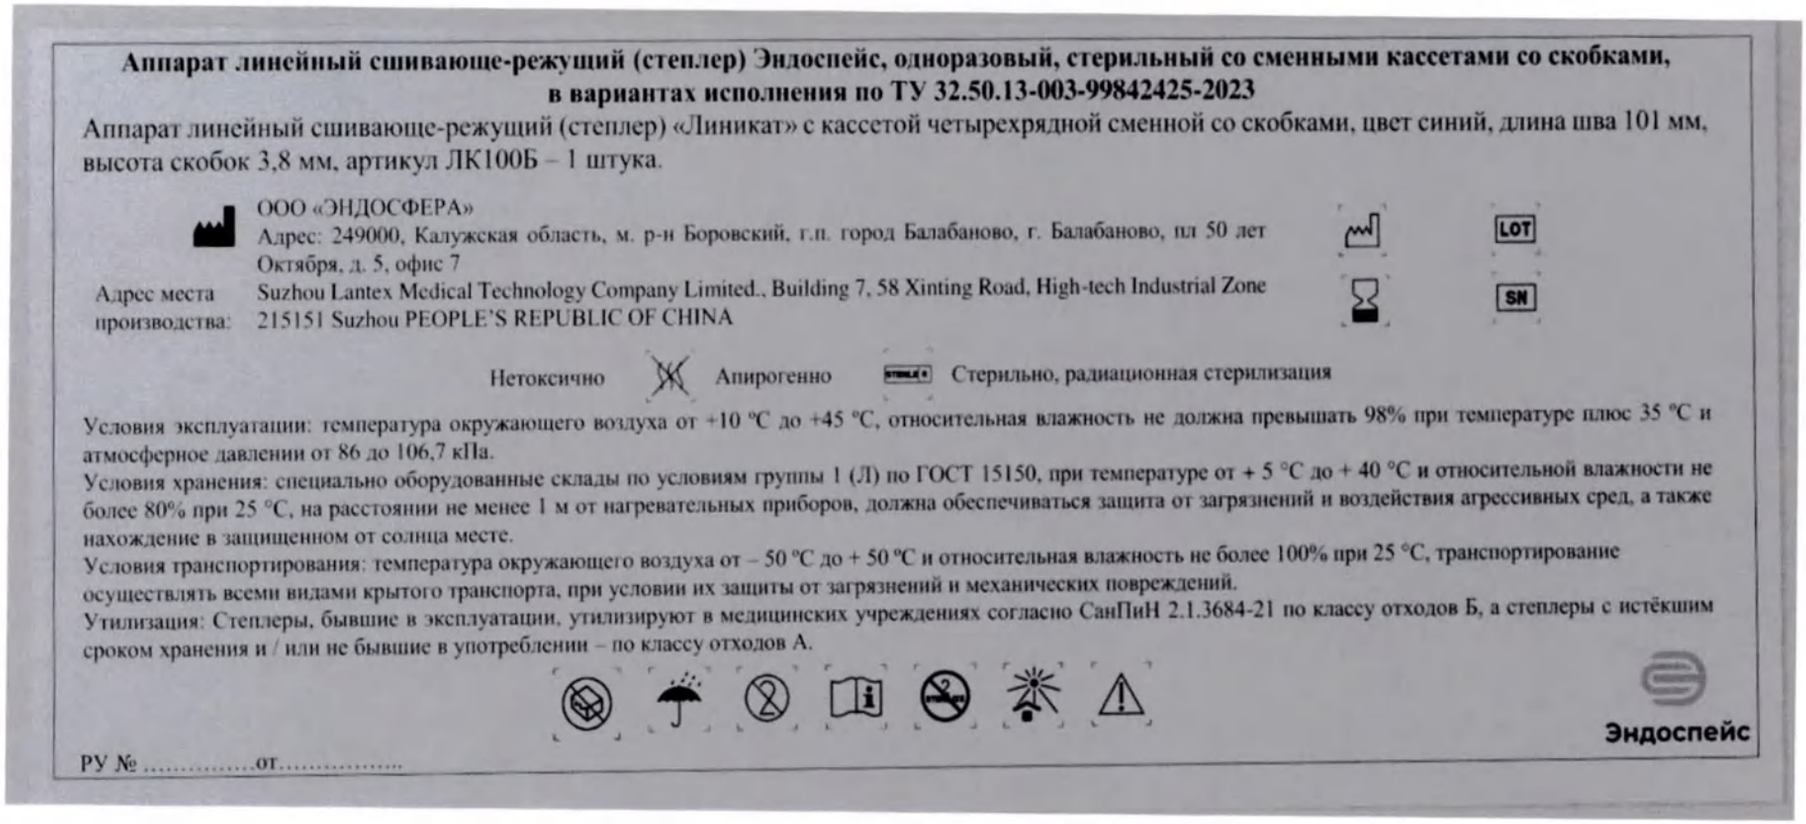

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № ……от……..

Рисунок 135А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

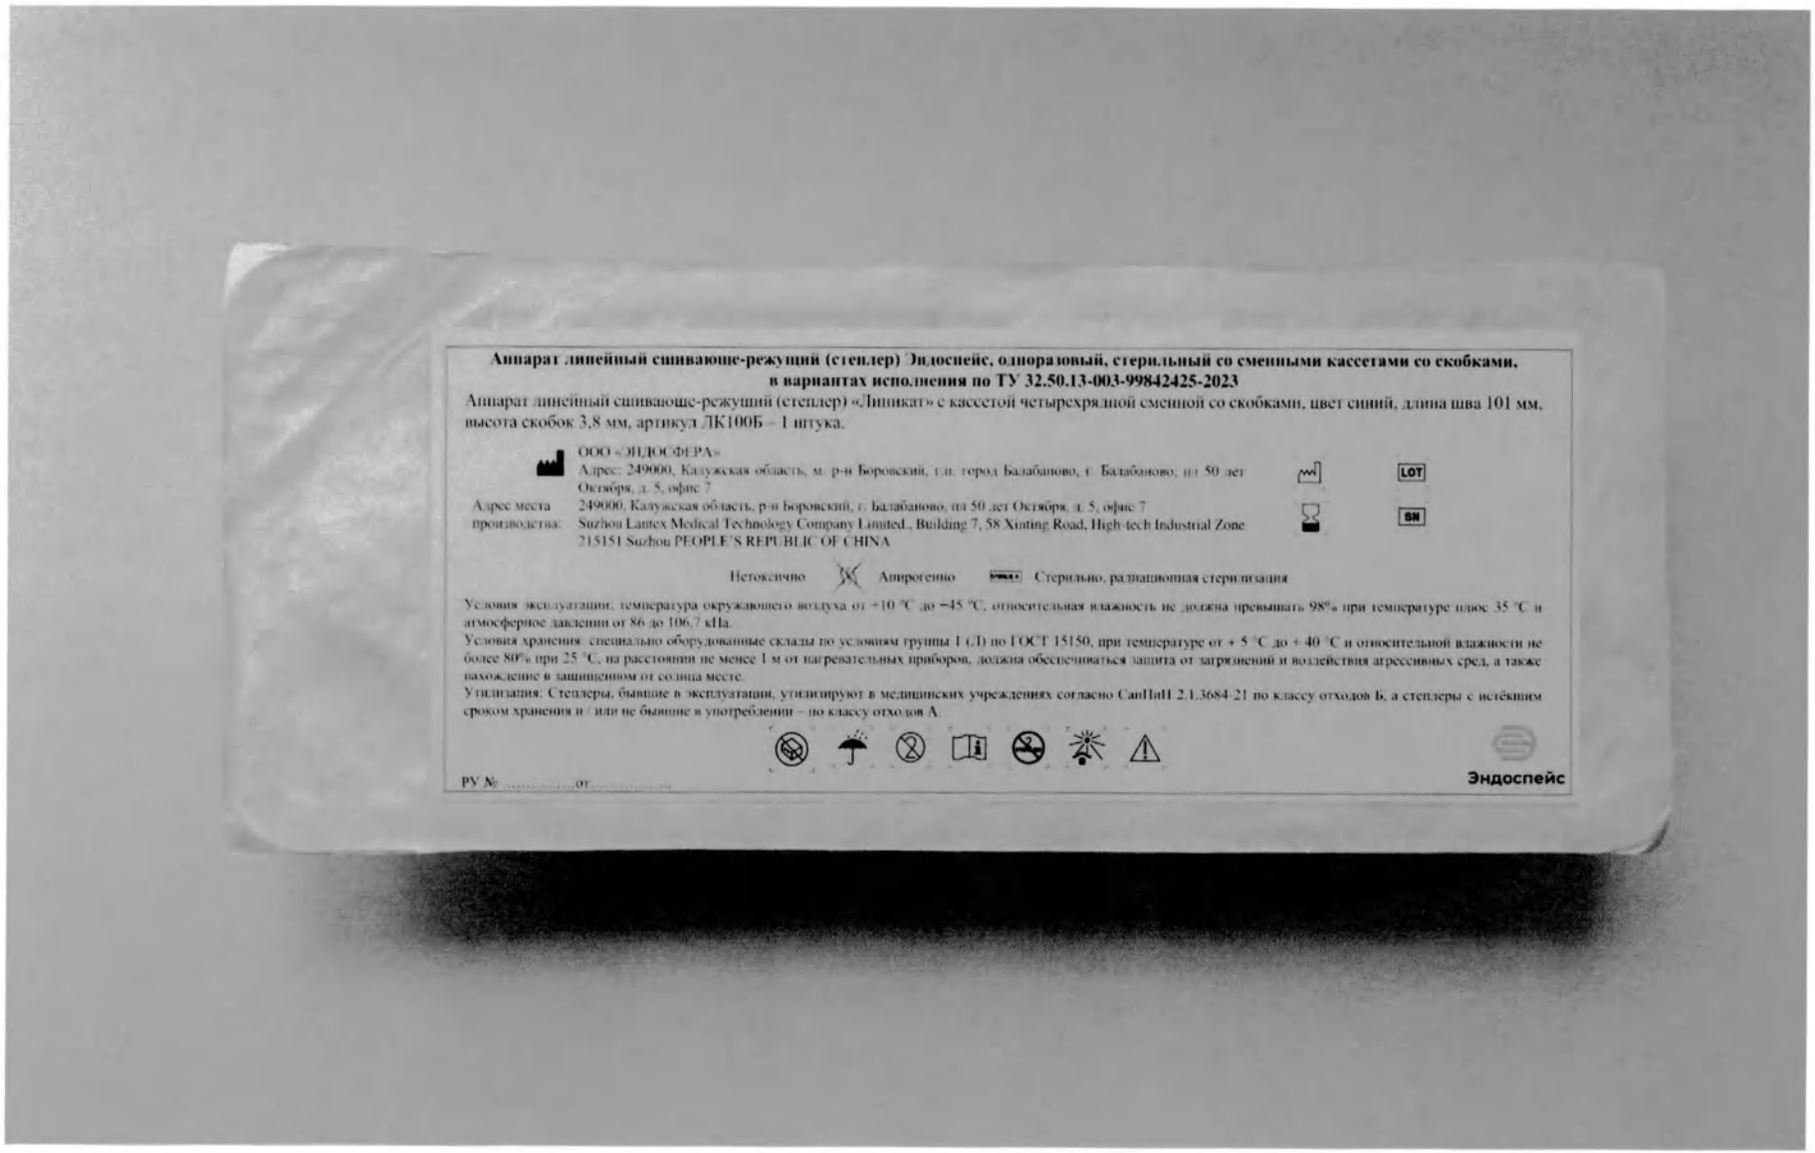

Рисунок 136 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 136А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

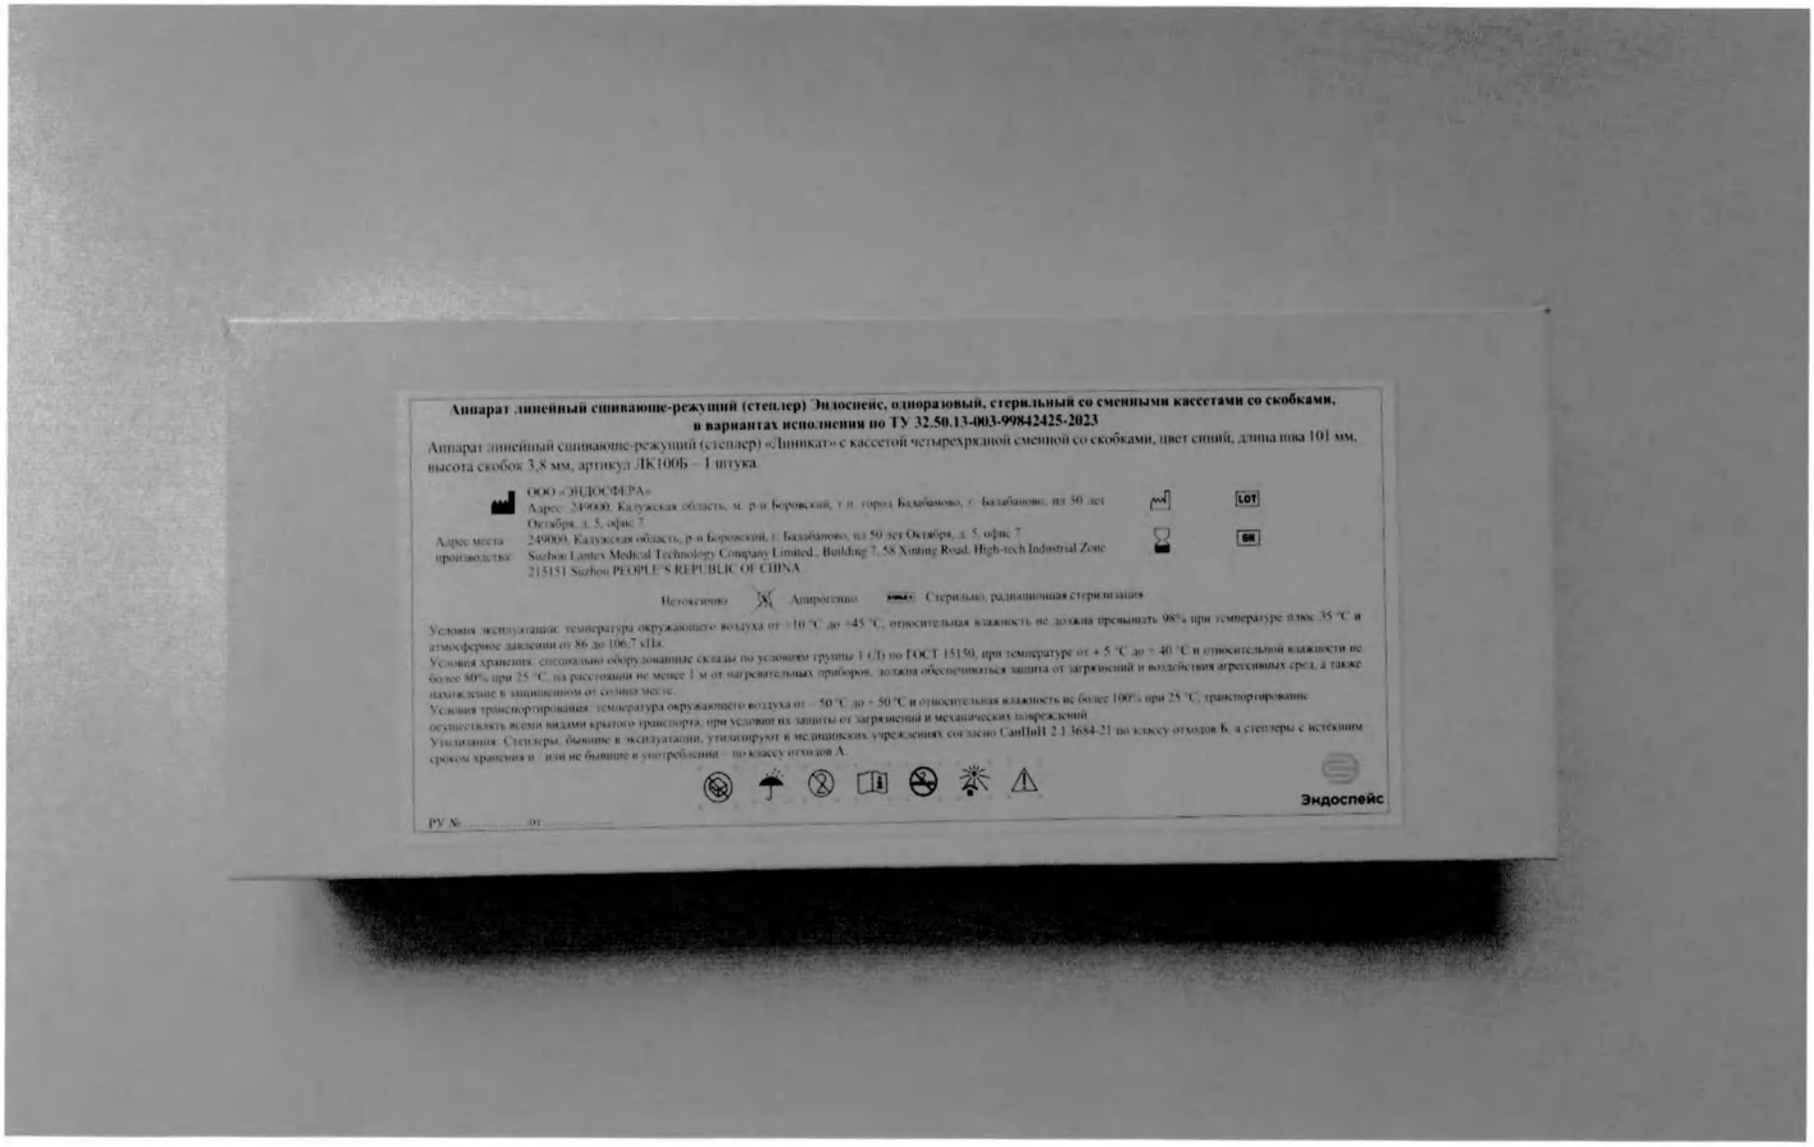

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, ул 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, ул 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № ..... от .....

Рисунок 137 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 137А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

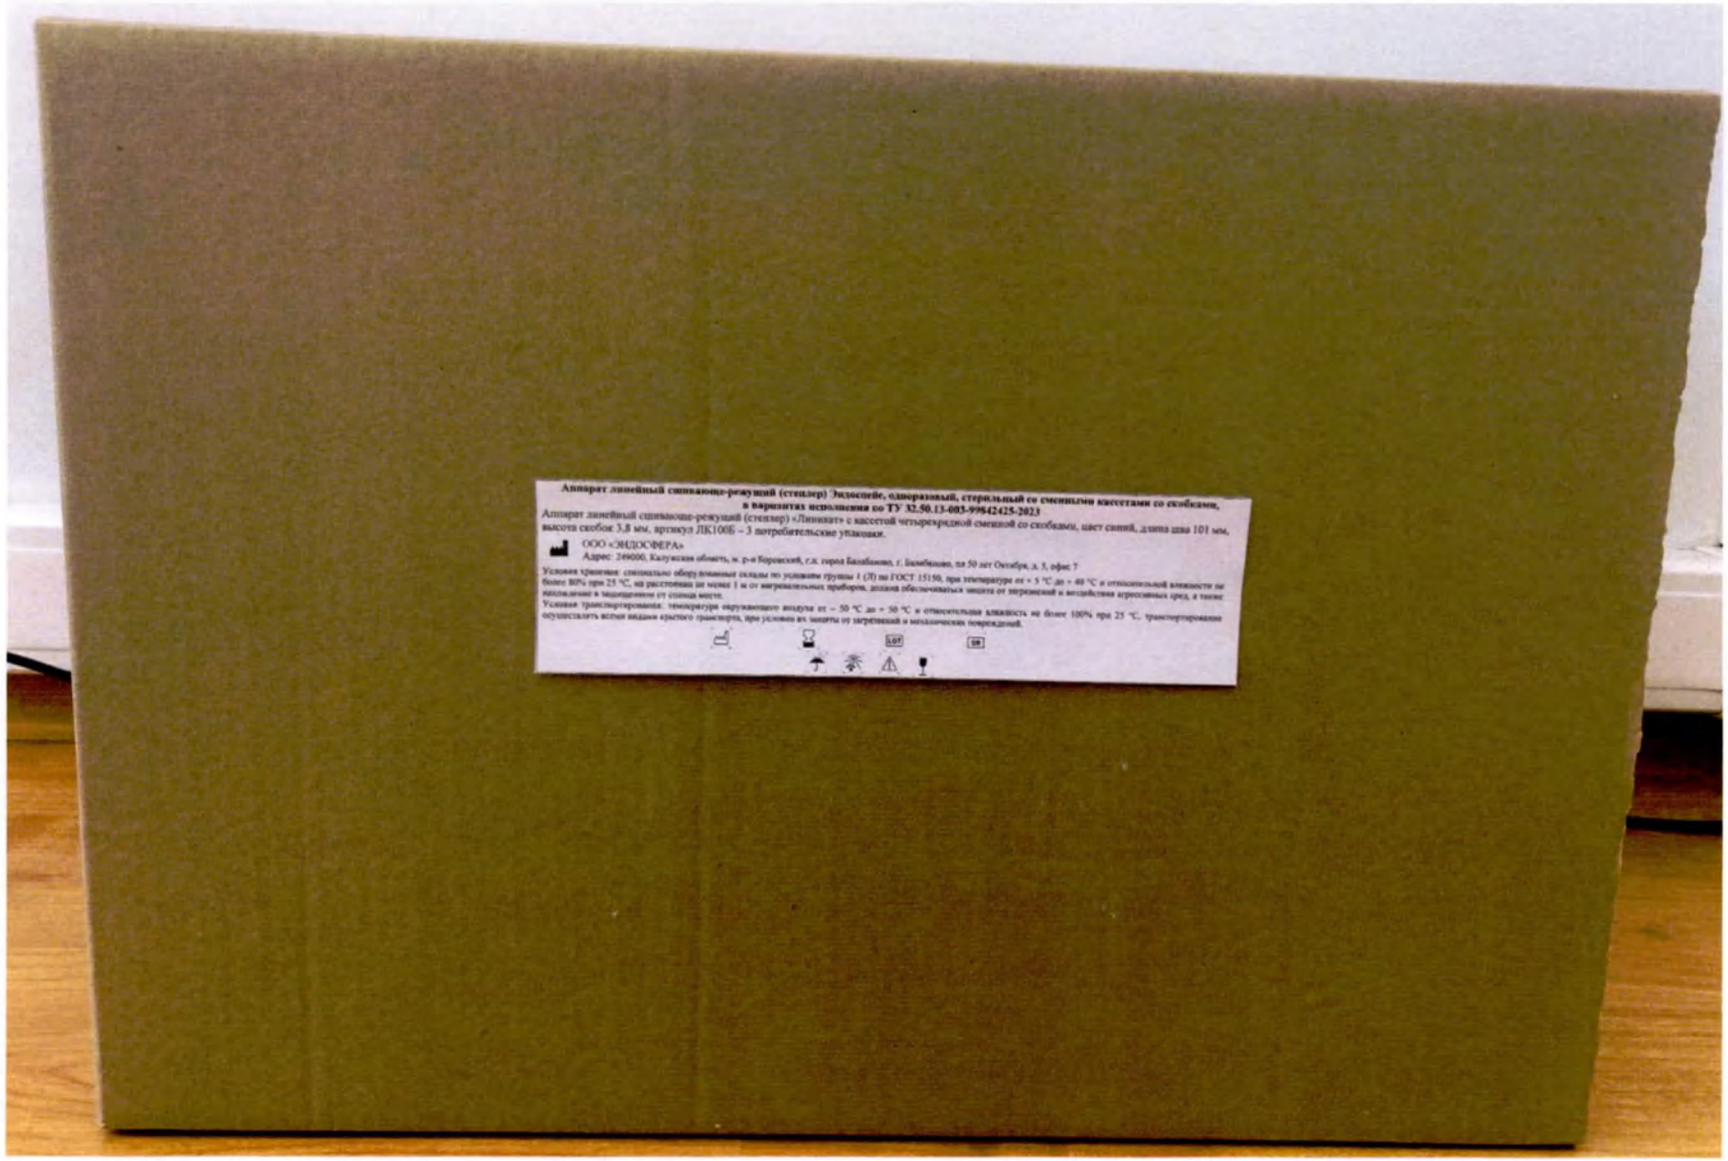

Рисунок 138 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

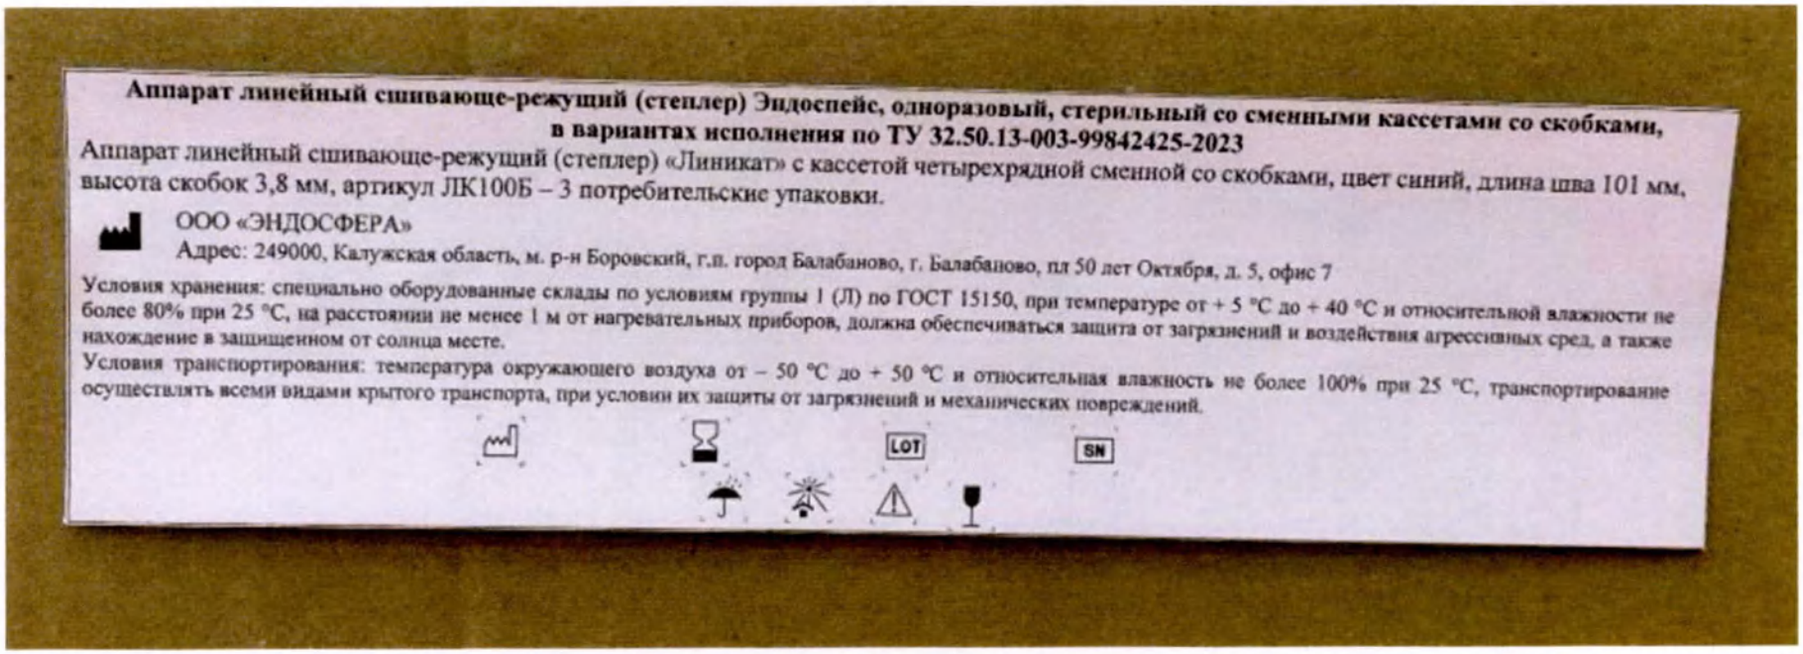

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

LOT

SN

Рисунок 138А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛК100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

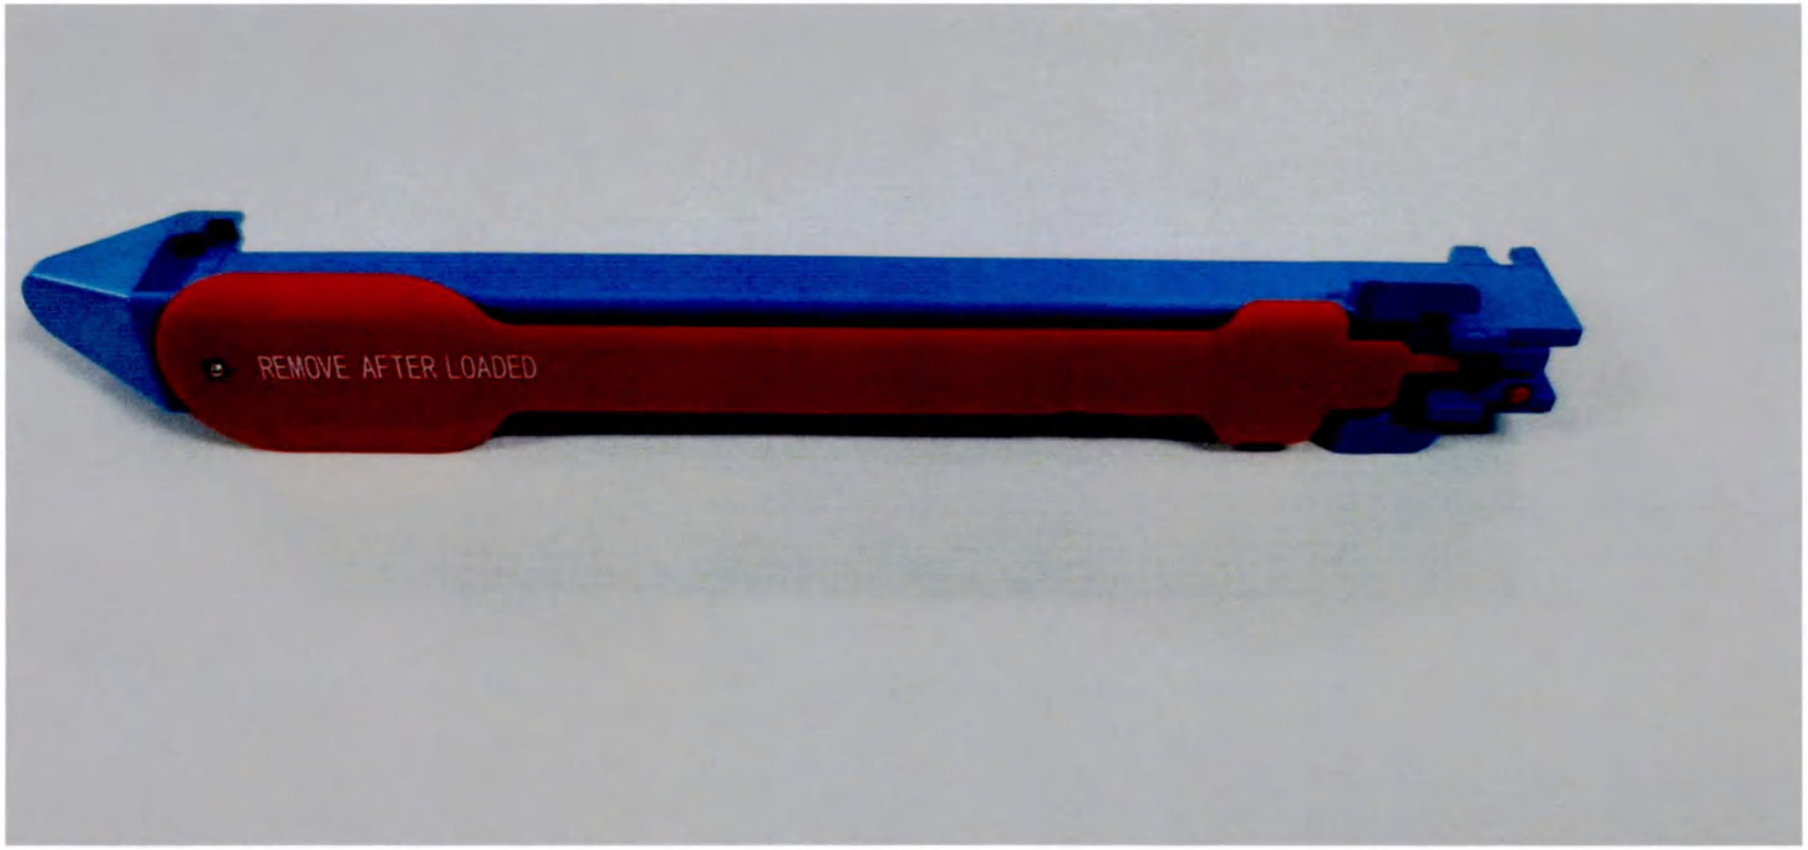

Рисунок 139 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 140 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

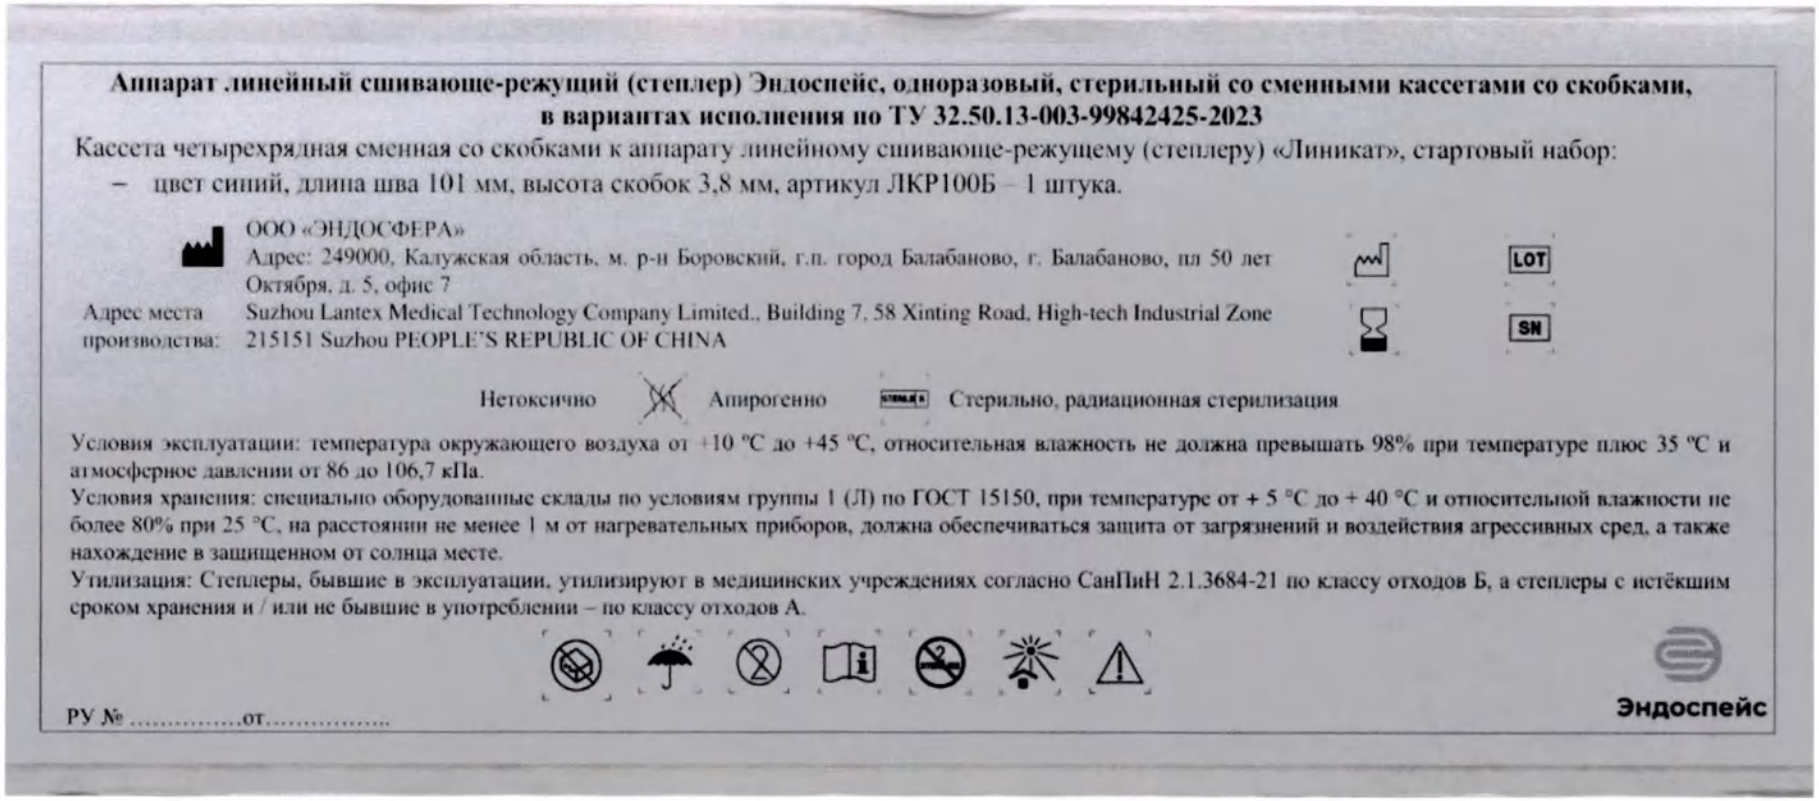

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 140А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

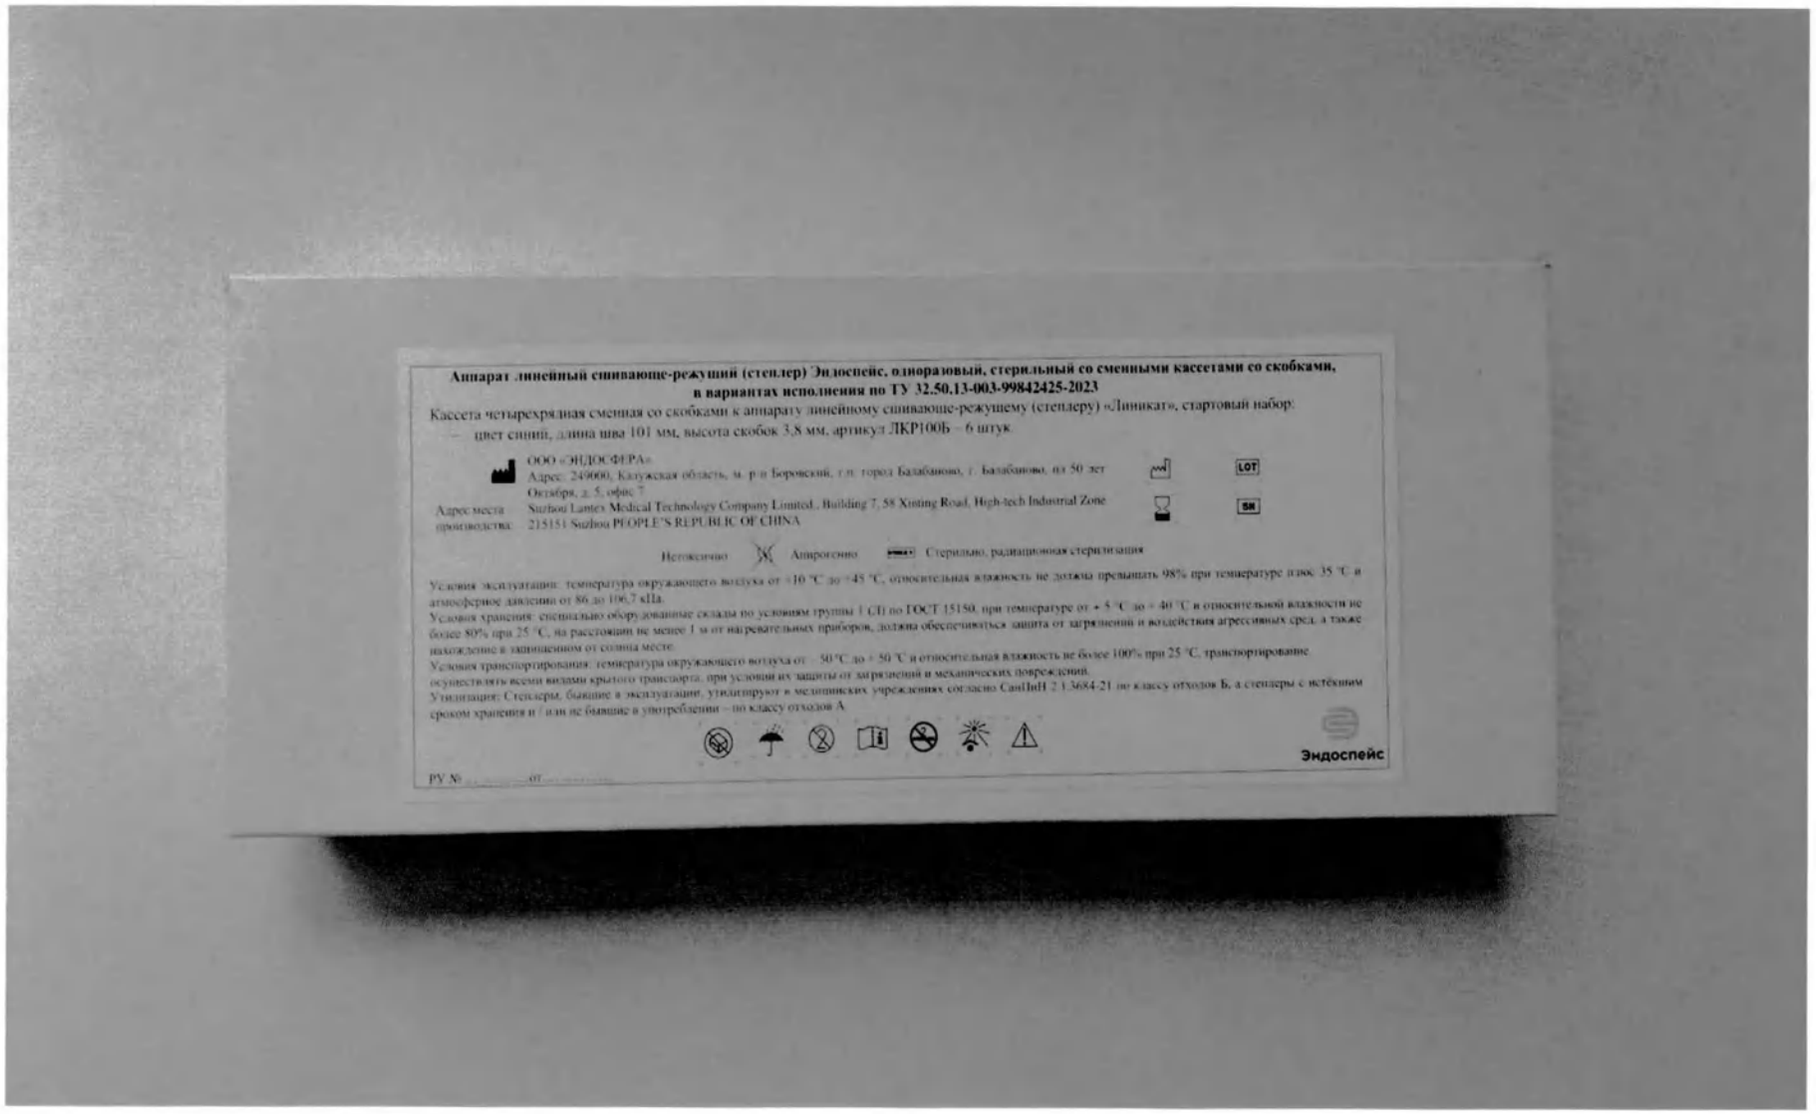

Рисунок 141 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

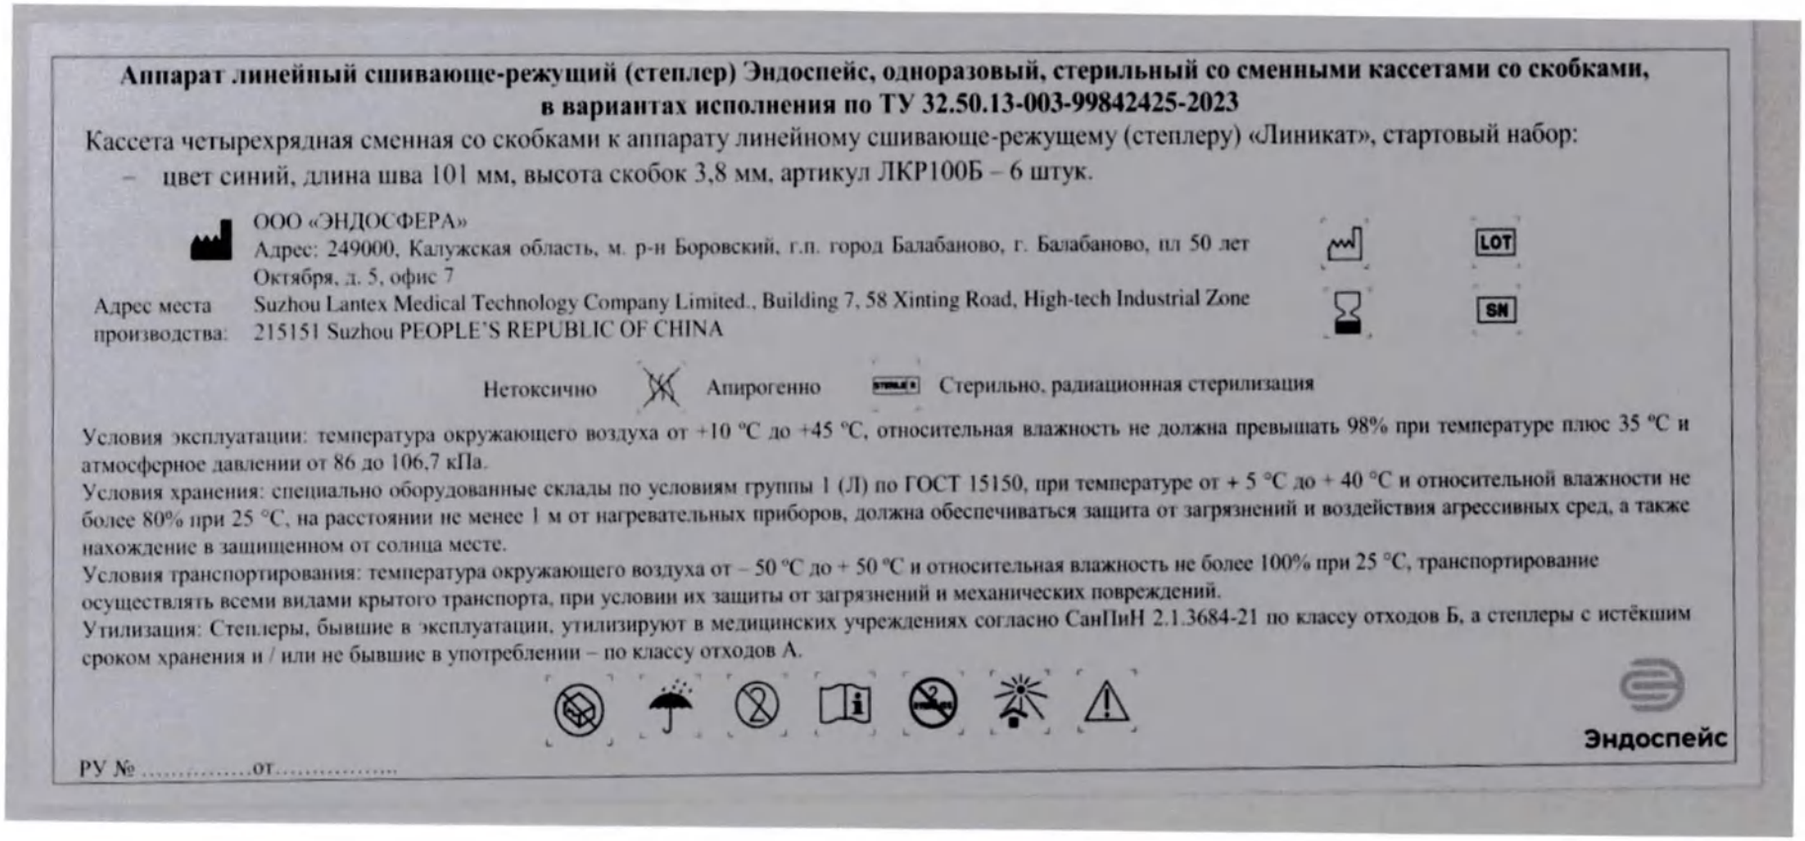

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 141А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 142 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

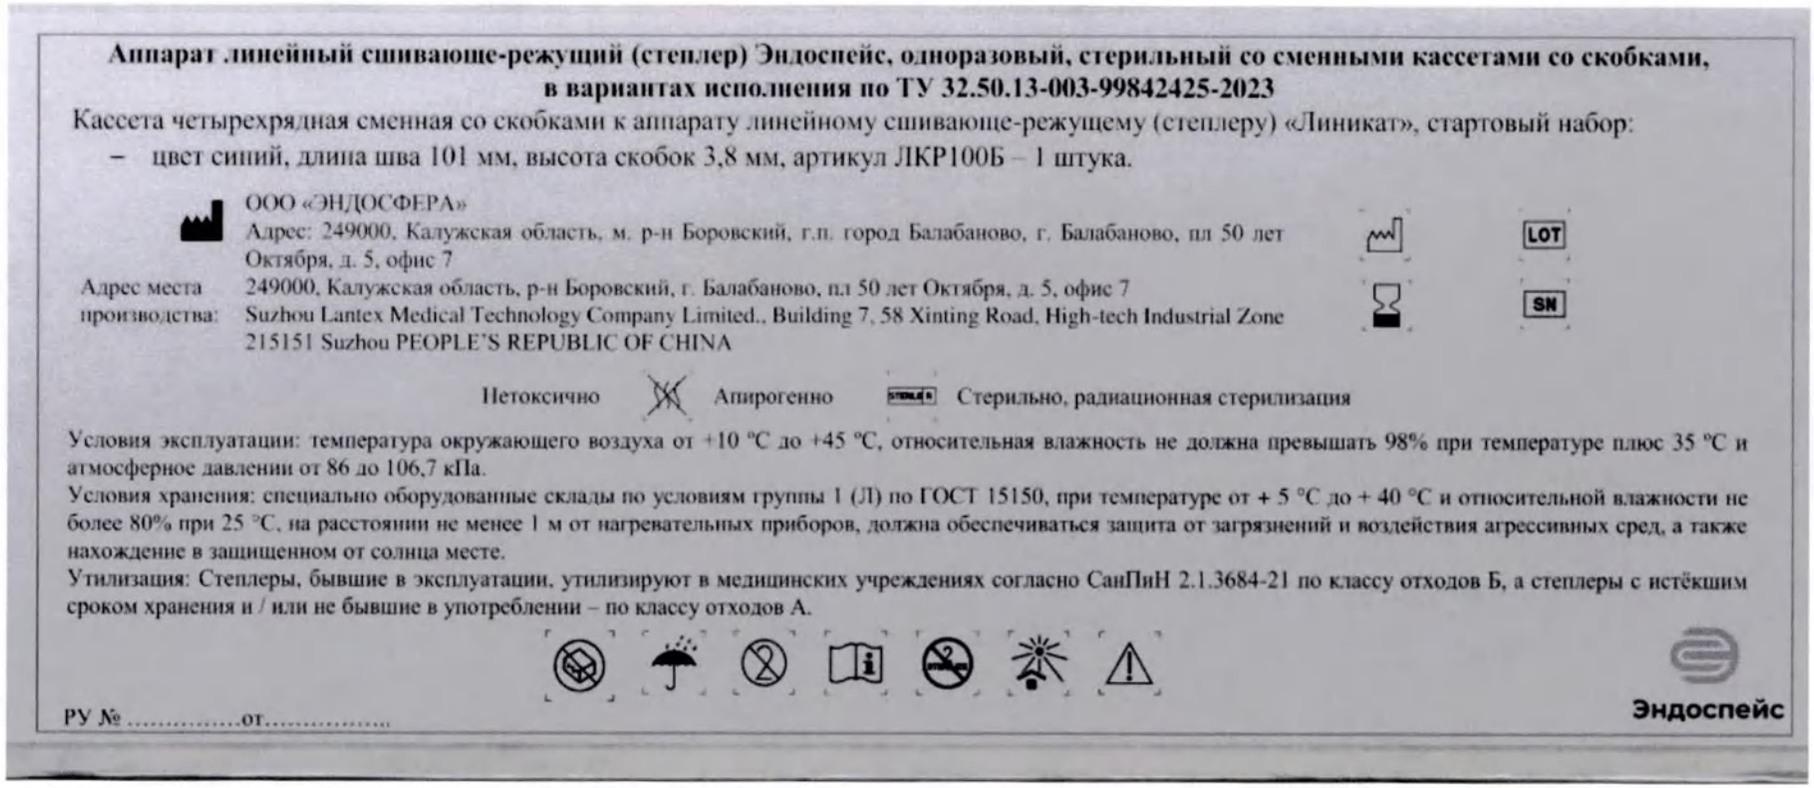

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 142А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

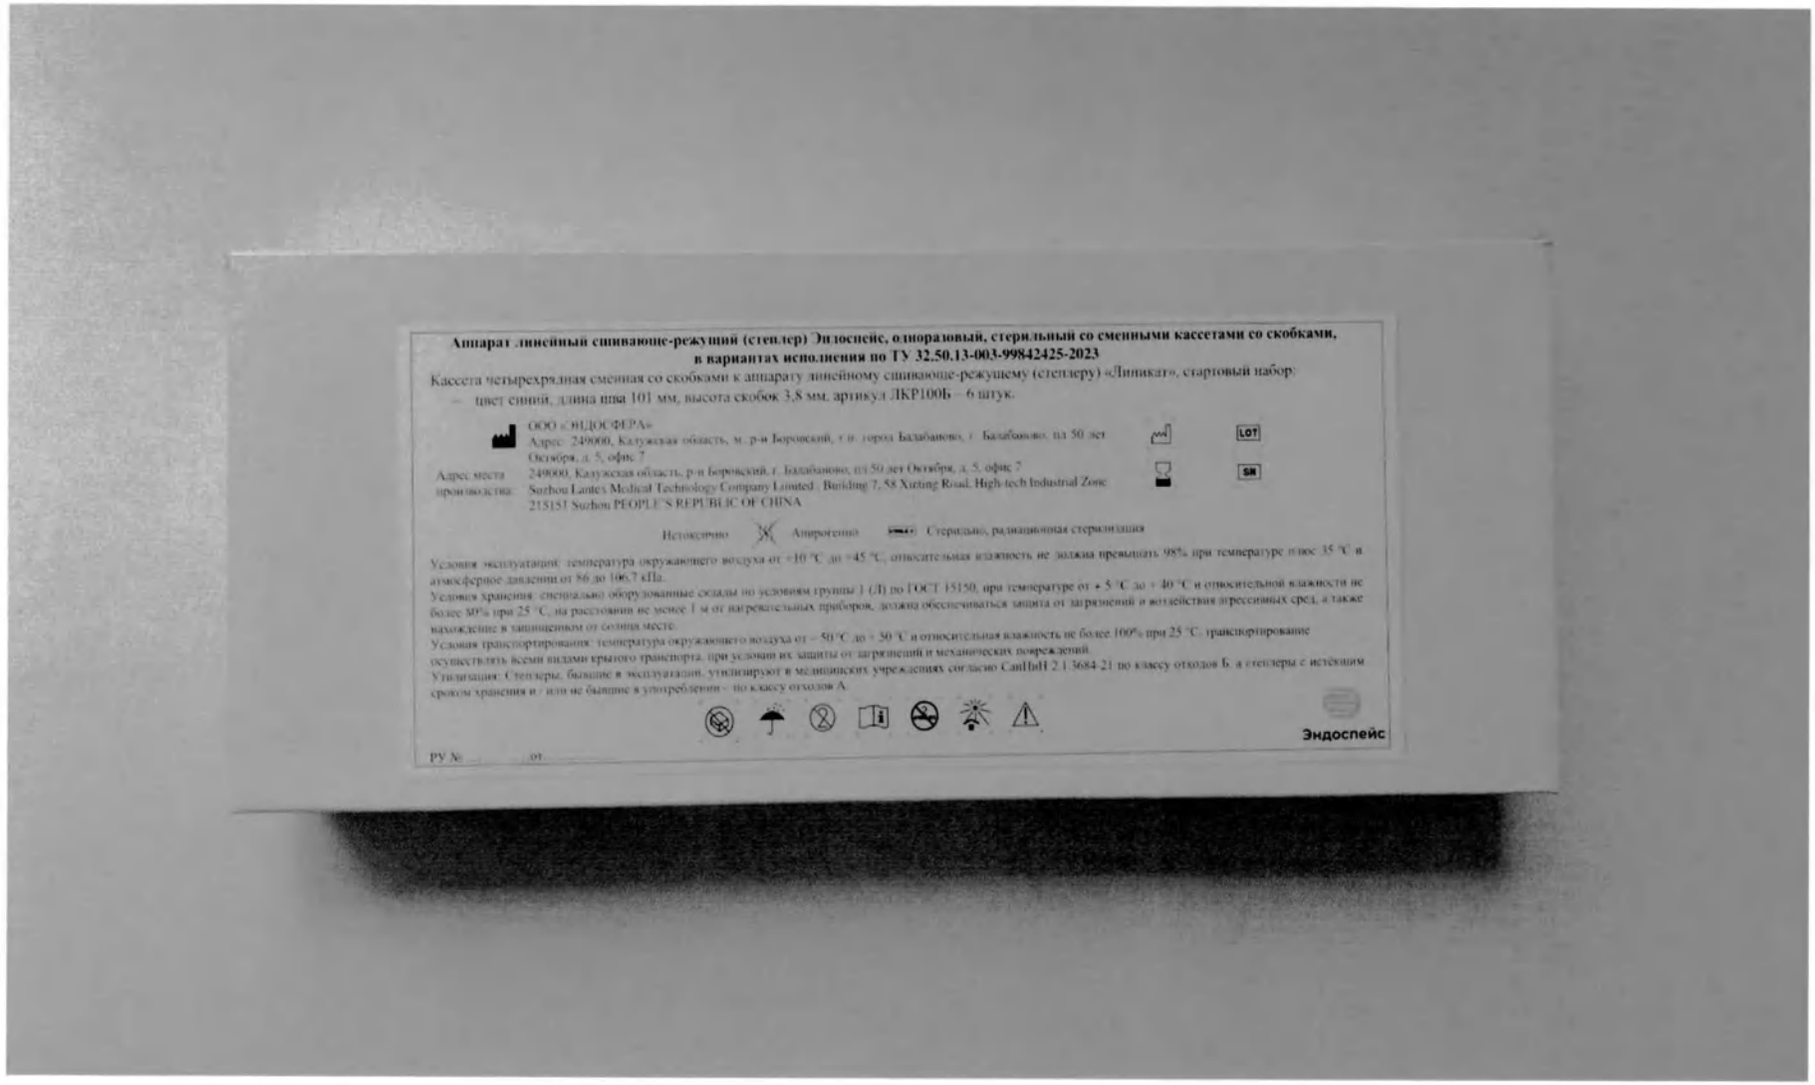

Рисунок 143 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

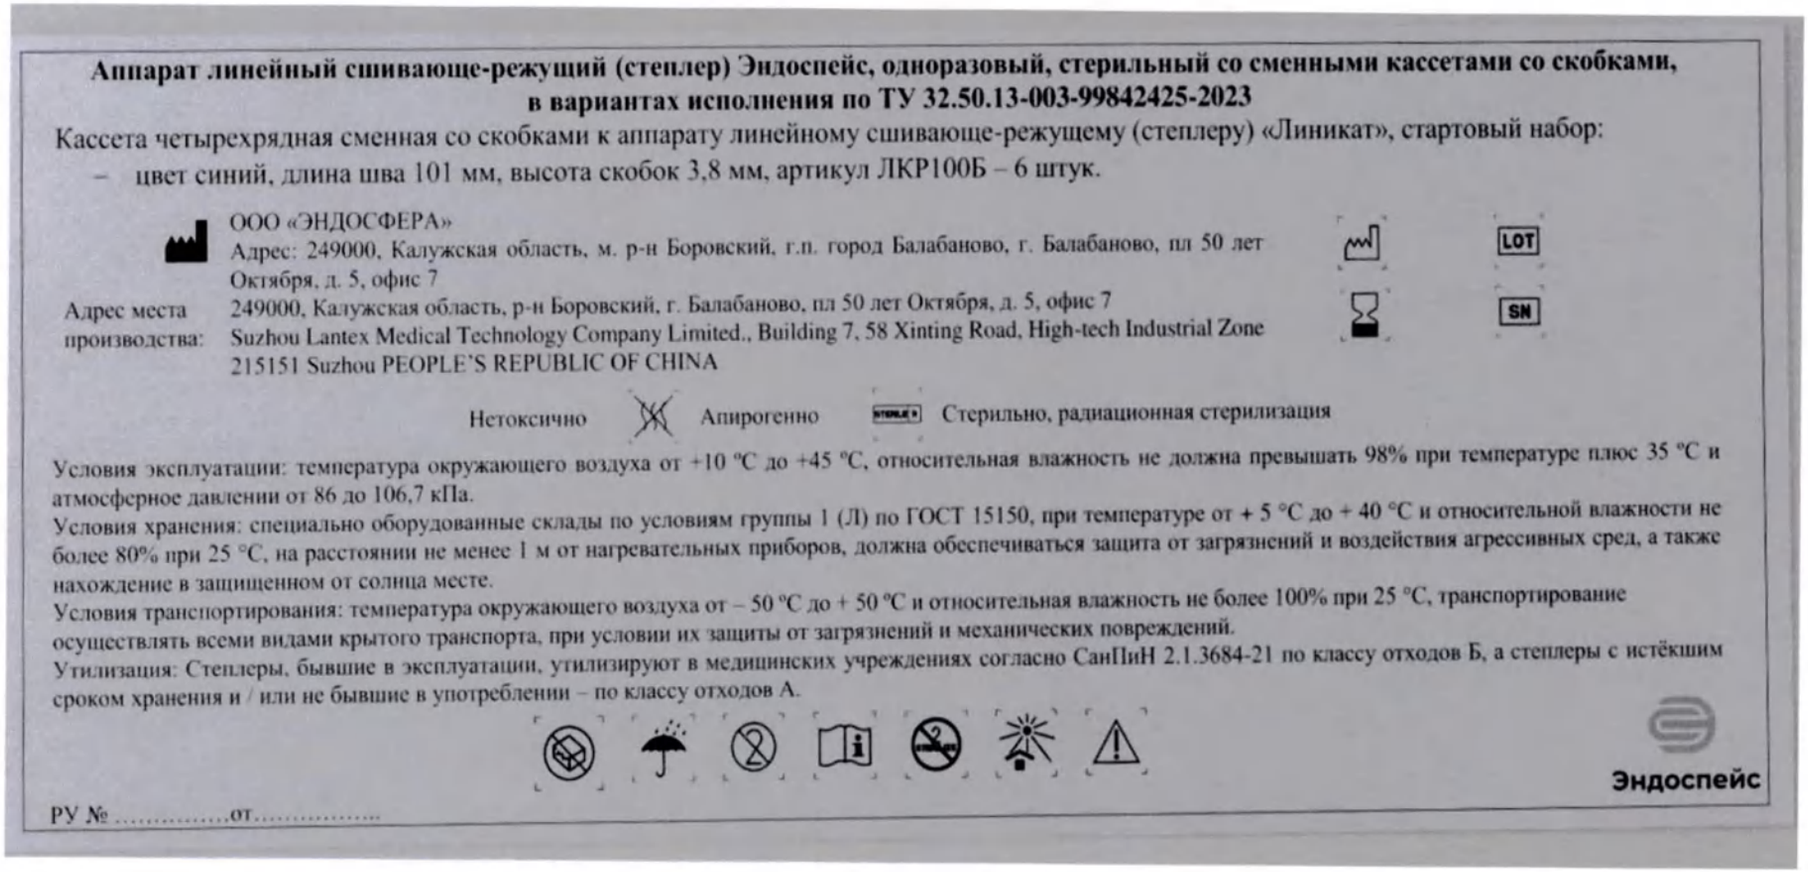

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 143А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 144 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

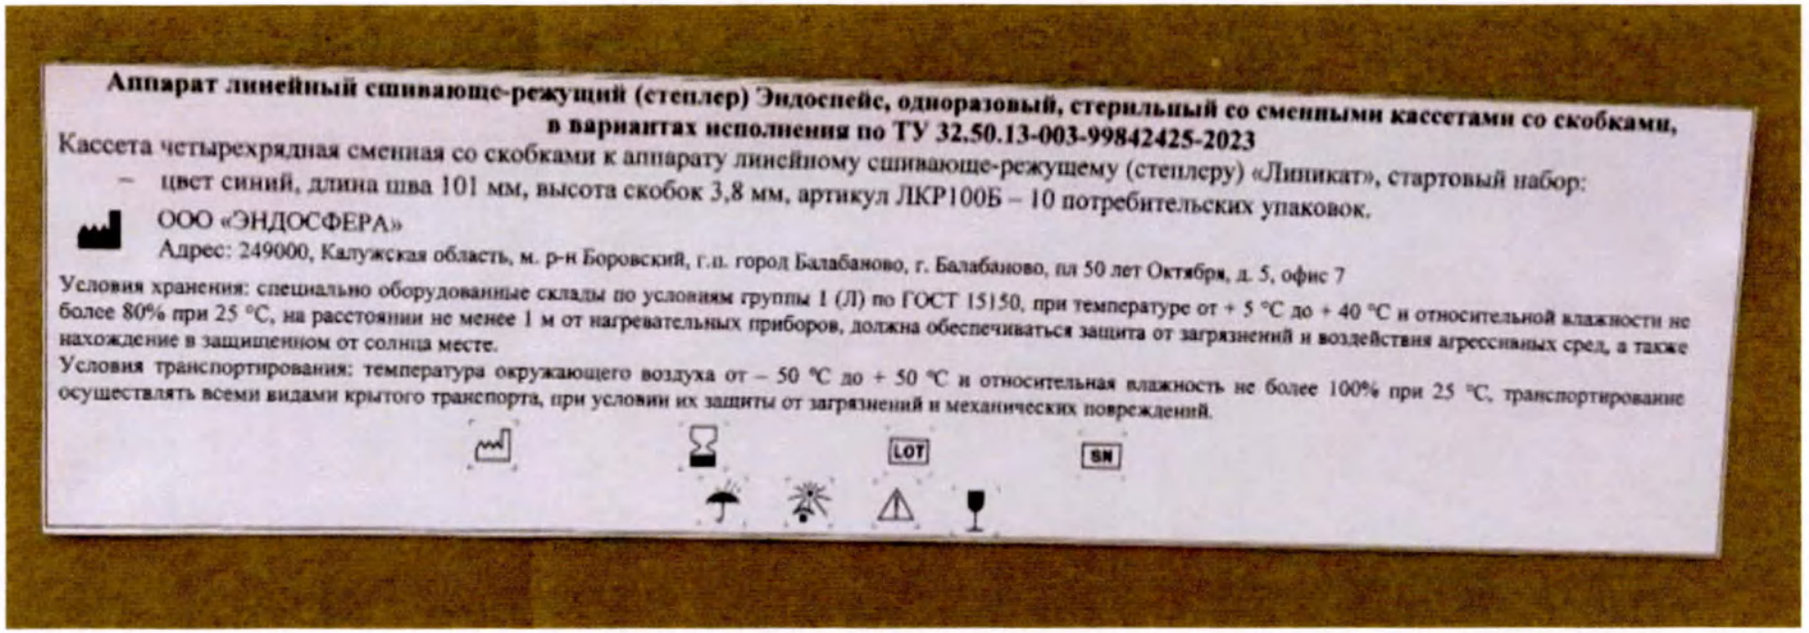

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

LOT

SN

Рисунок 144А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:
цвет синий, длина шва 101 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ЛКР100Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 145 – Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

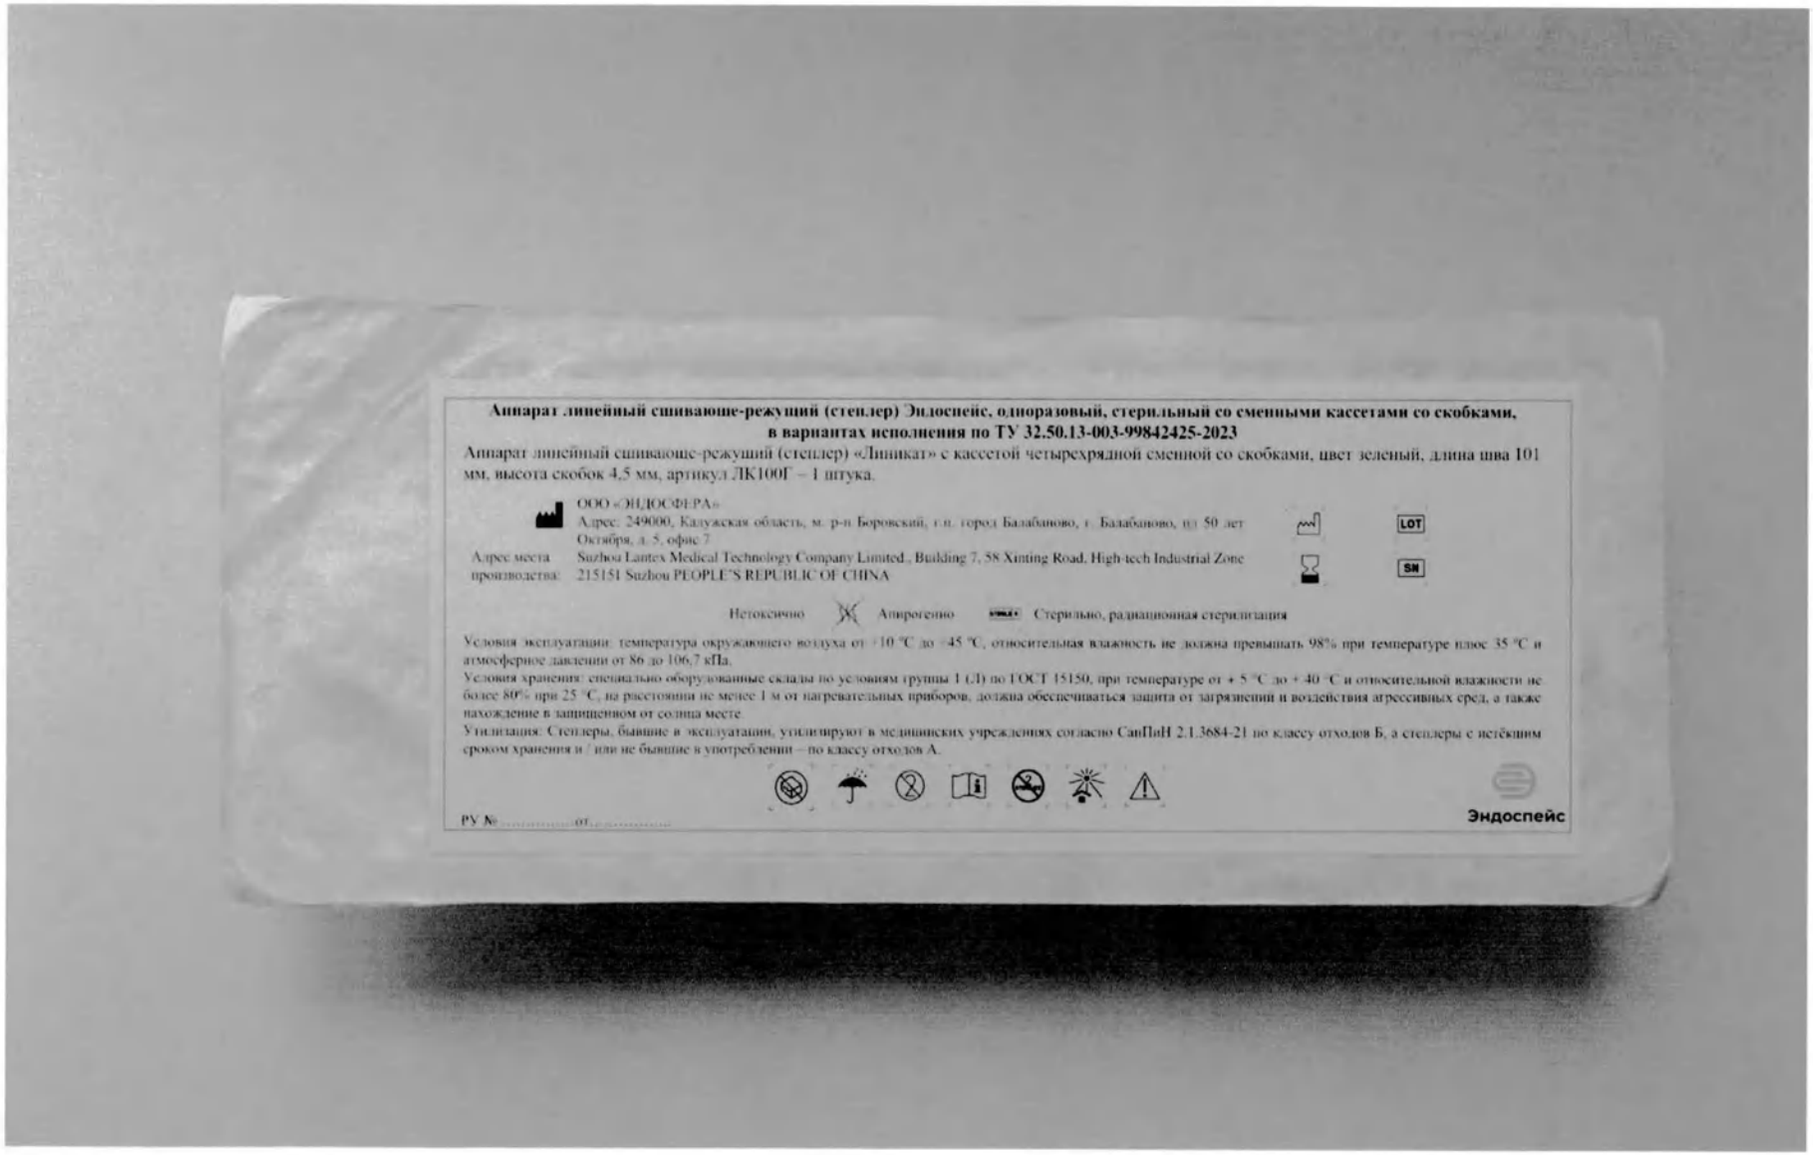

Рисунок 146 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 146А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

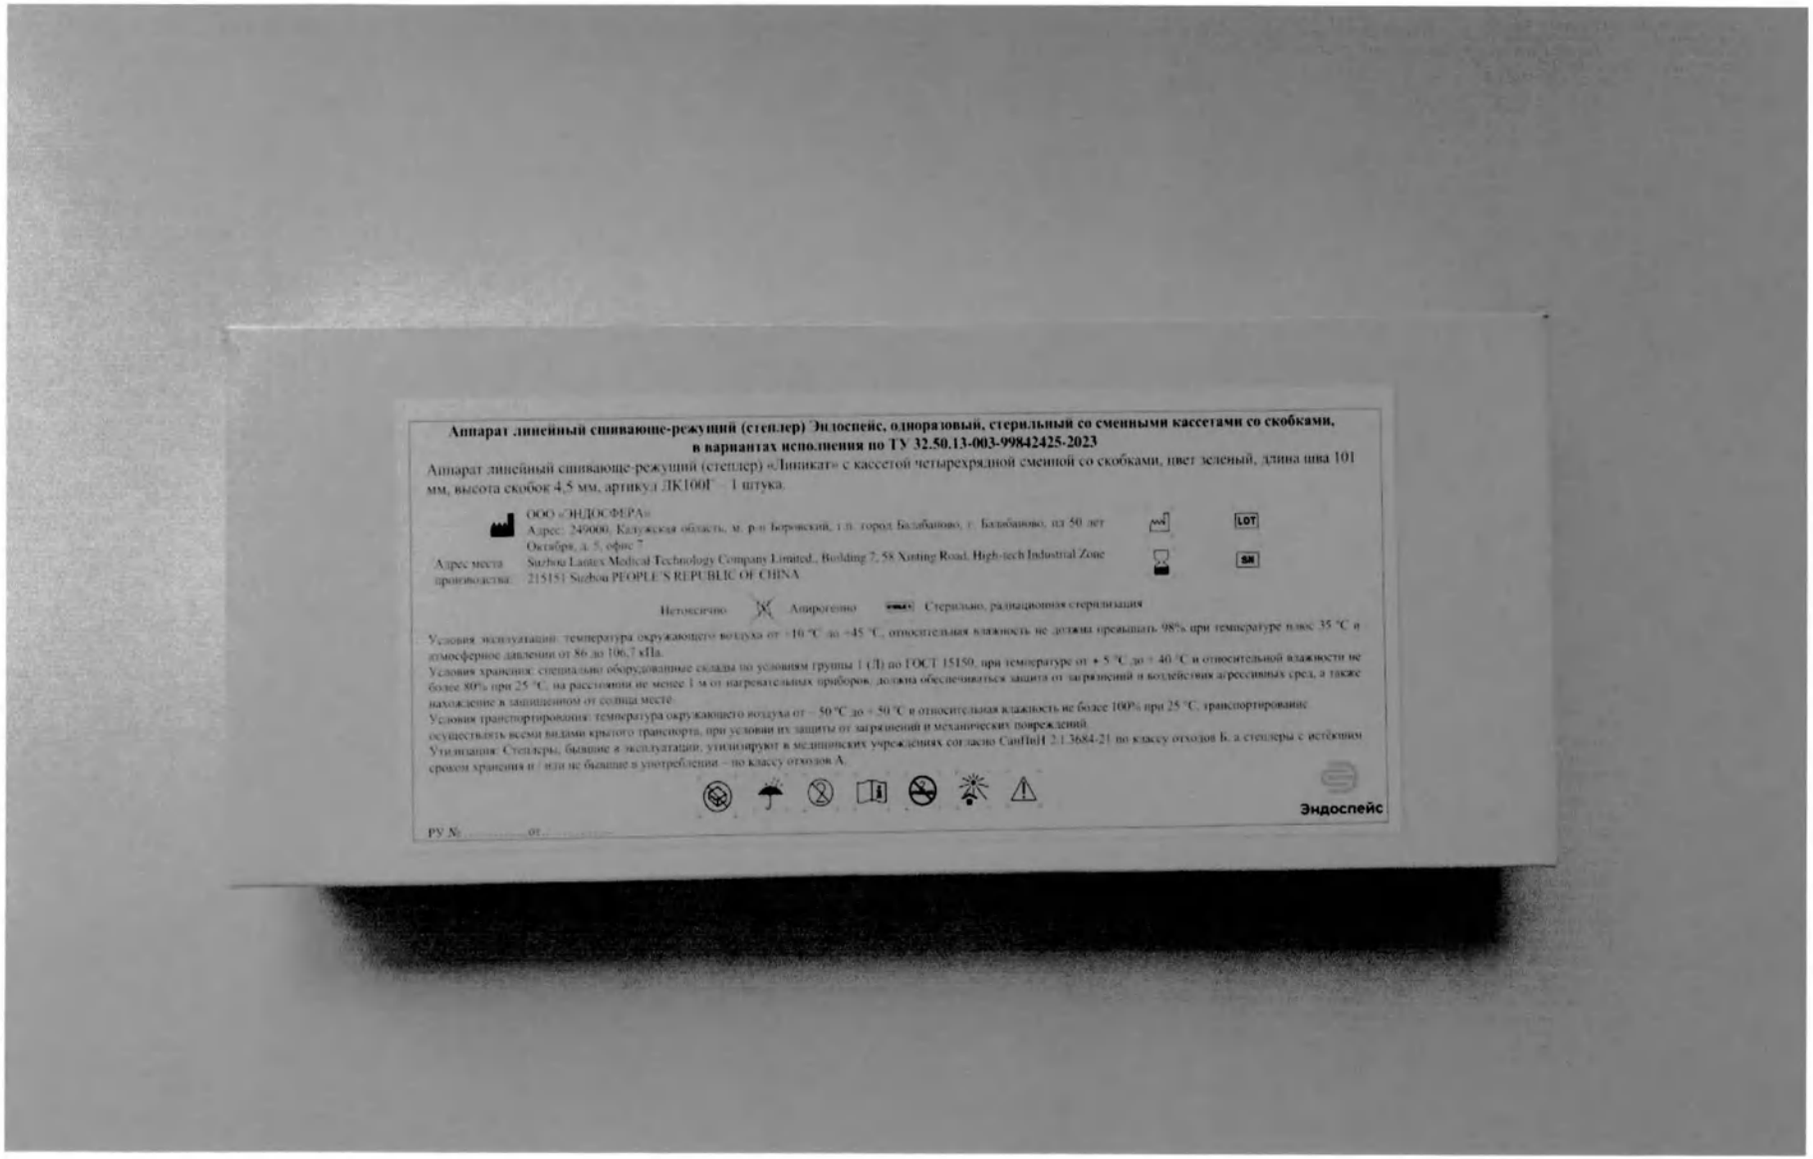

Рисунок 147 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

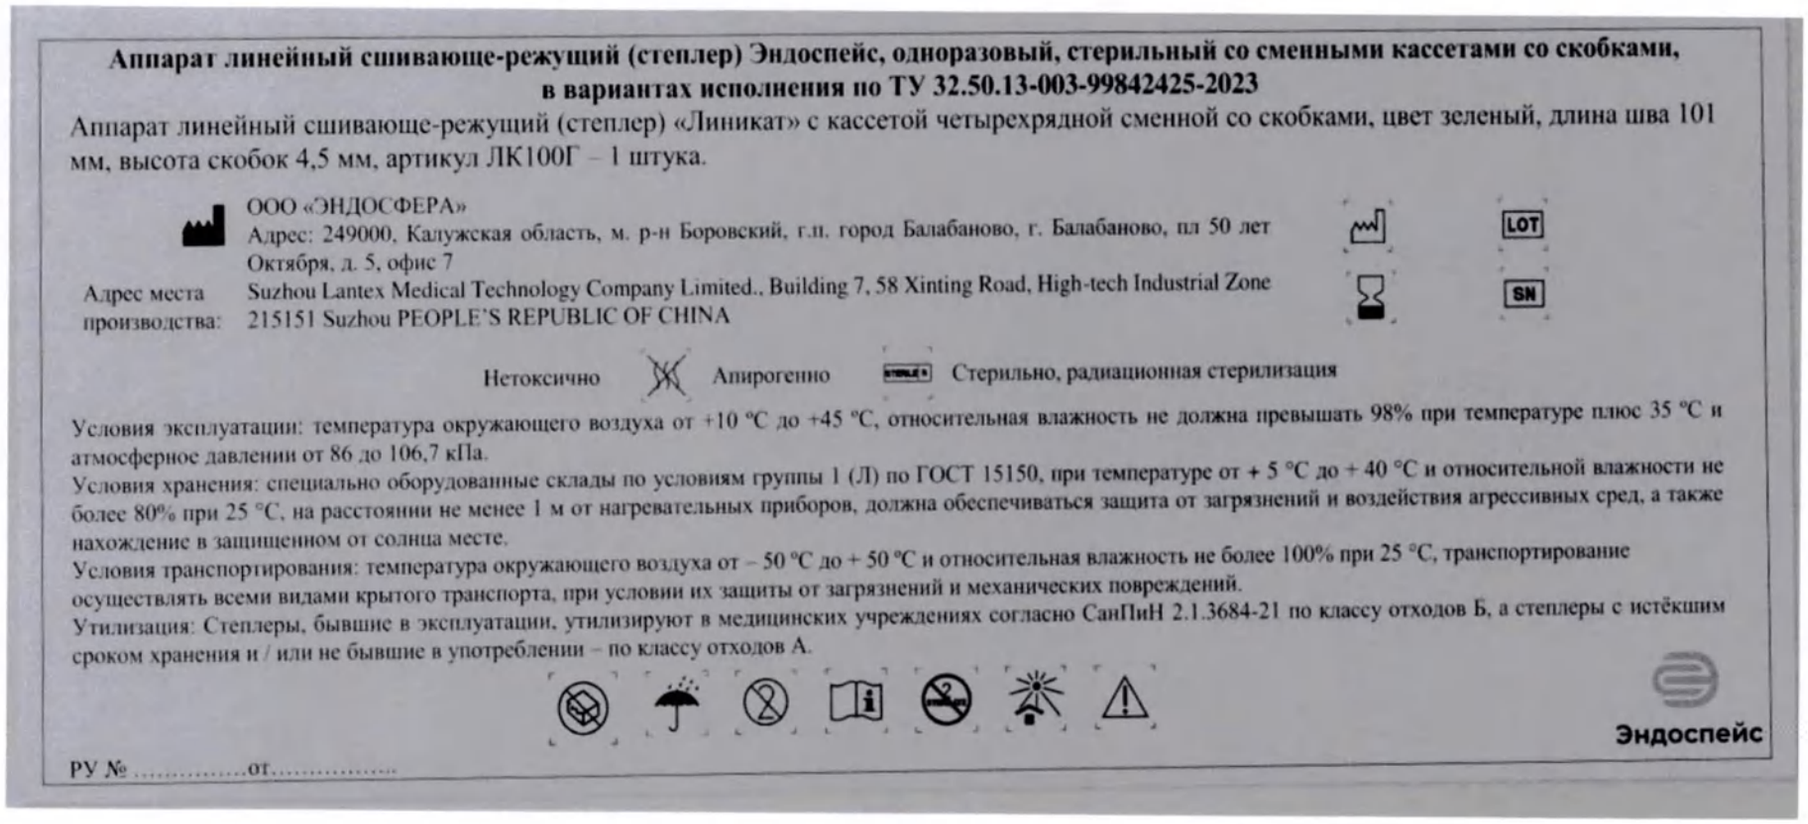

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 147А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 148 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 148А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

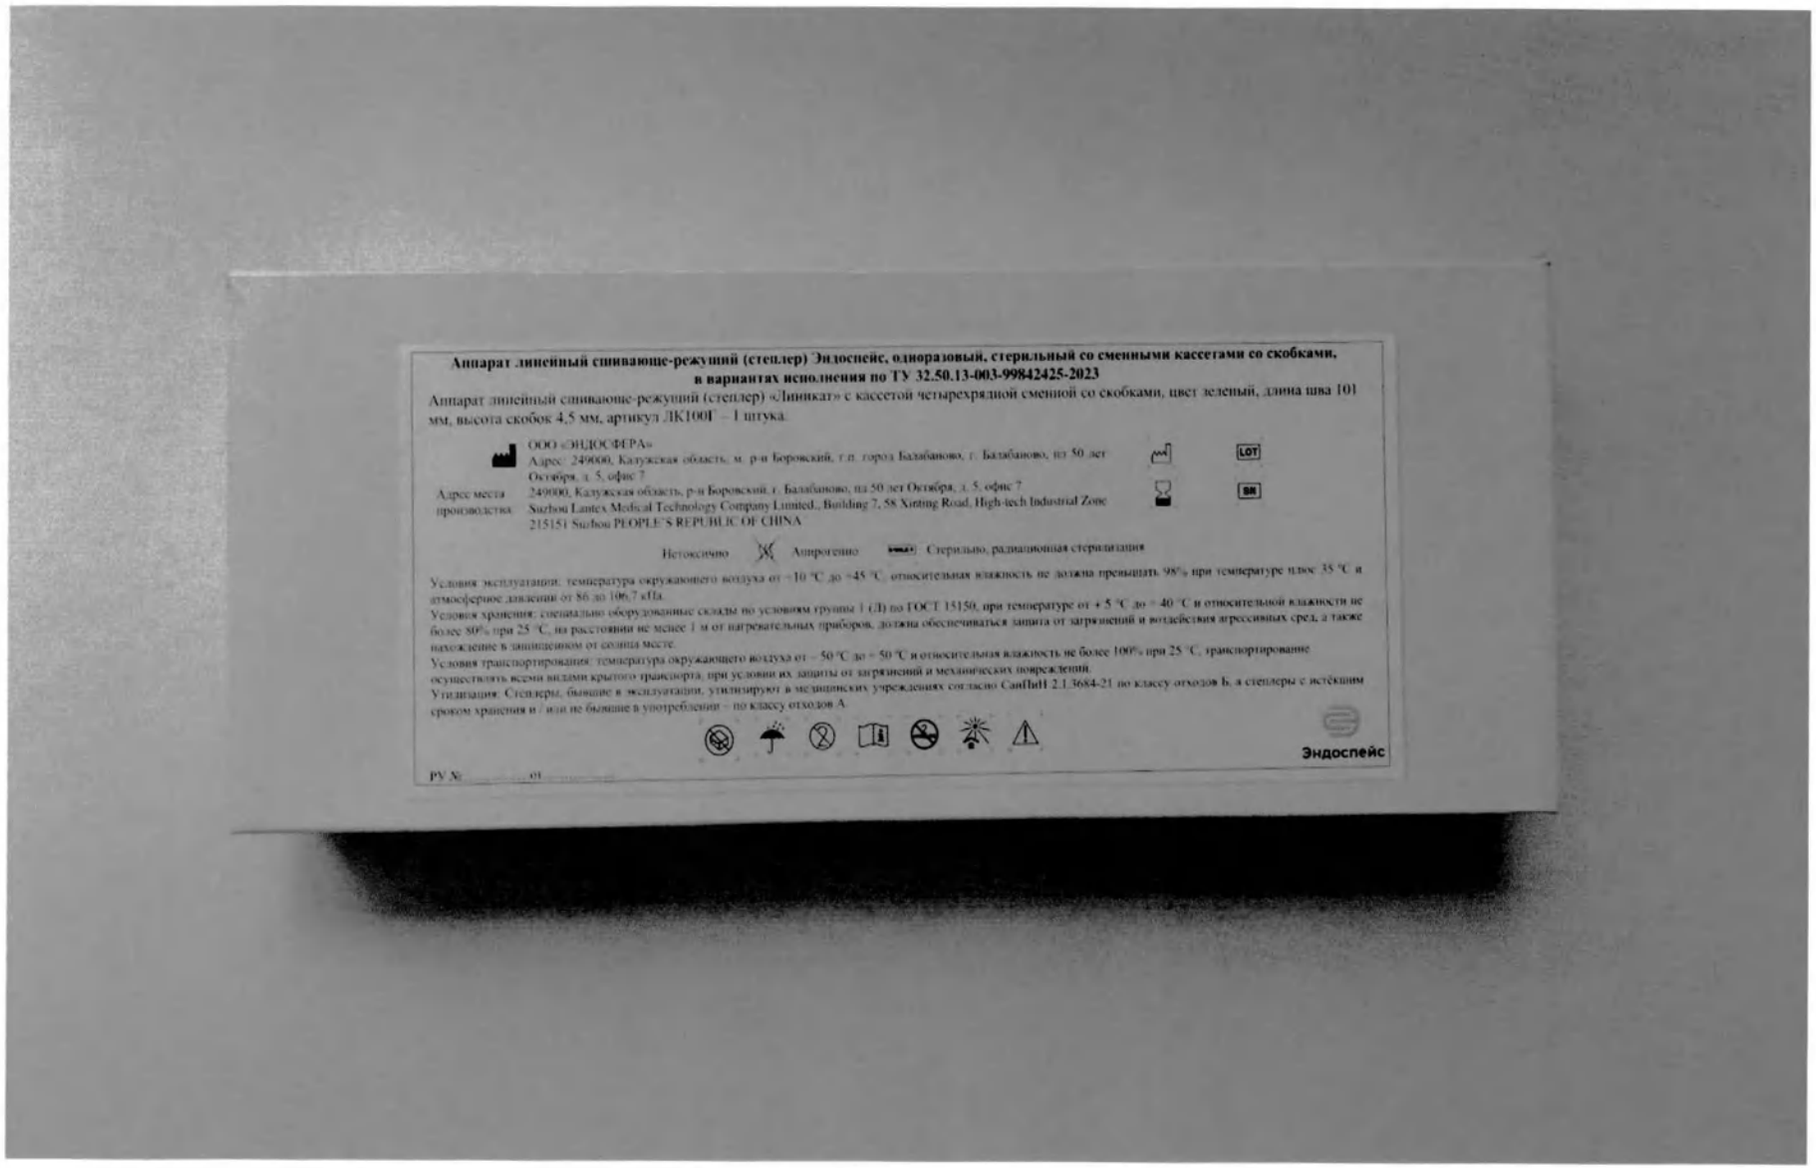

Рисунок 149 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 149А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

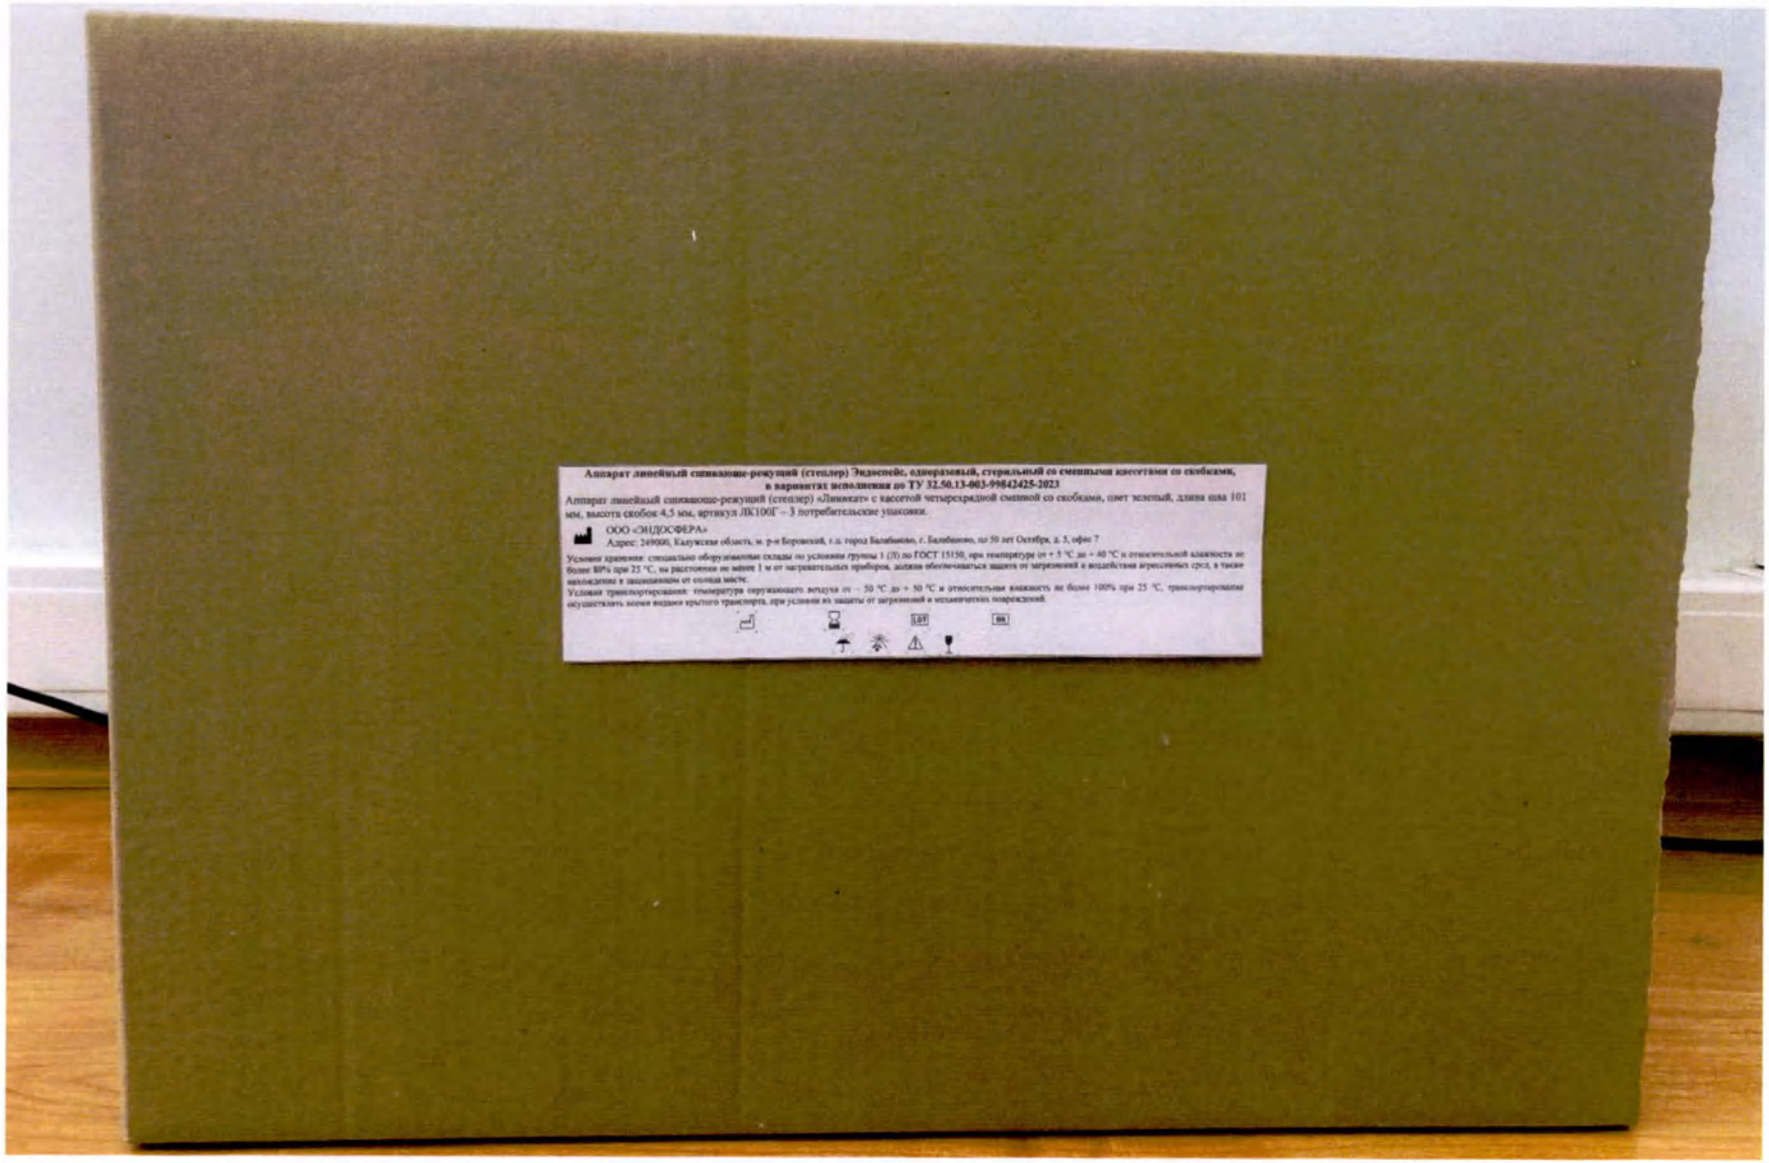

Рисунок 150 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

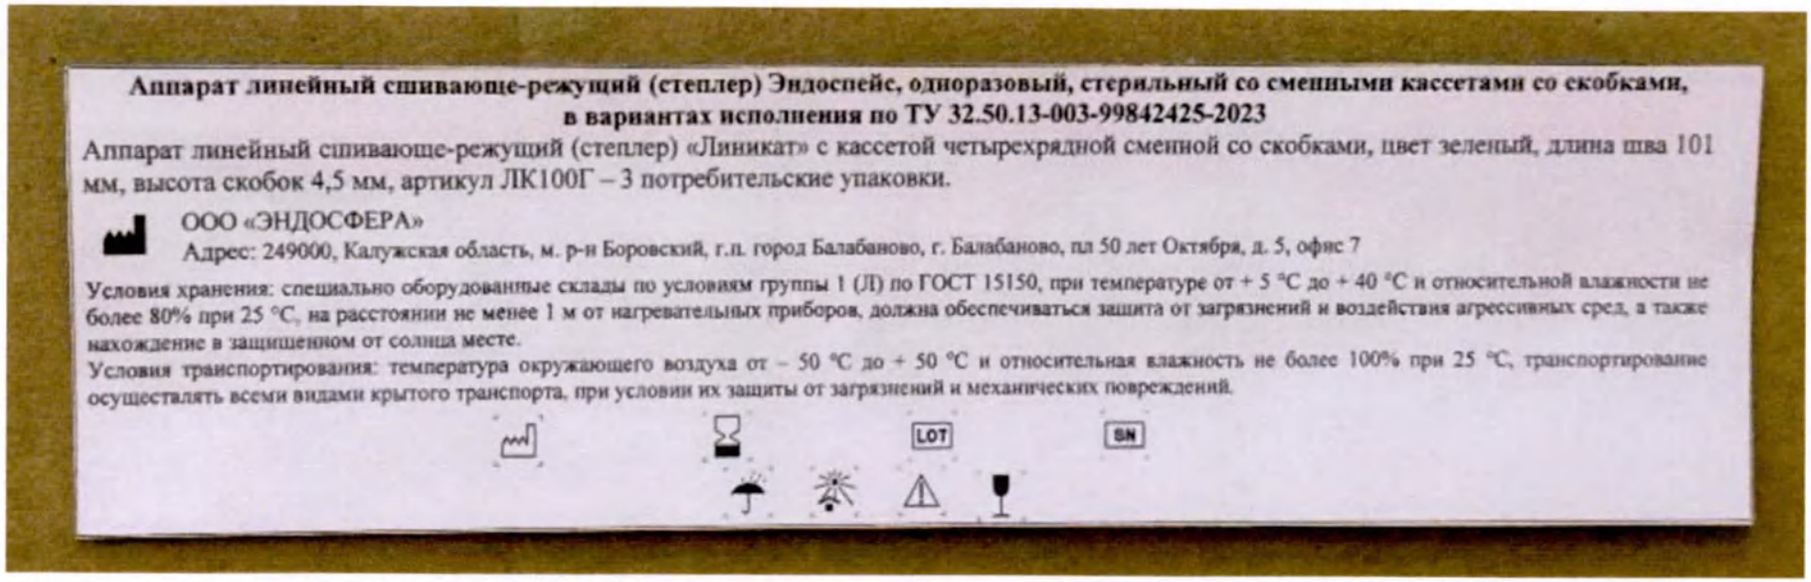

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 150А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающе-режущего (степлера) «Линикат» с кассетой четырехрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛК100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

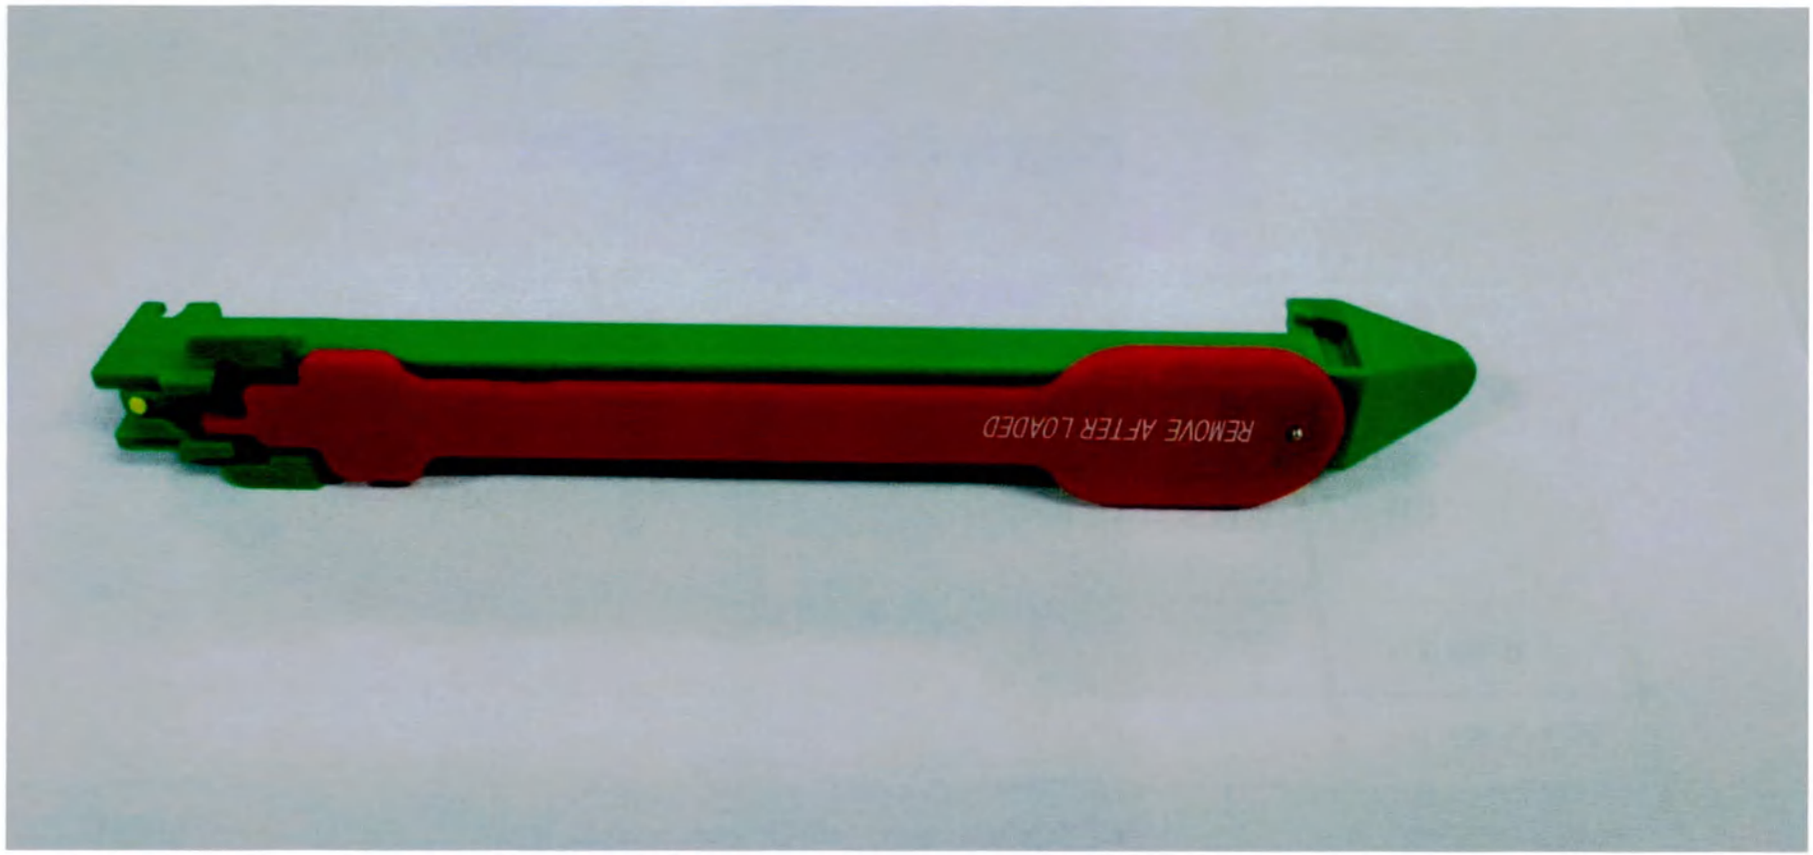

Рисунок 151 – Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 152 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

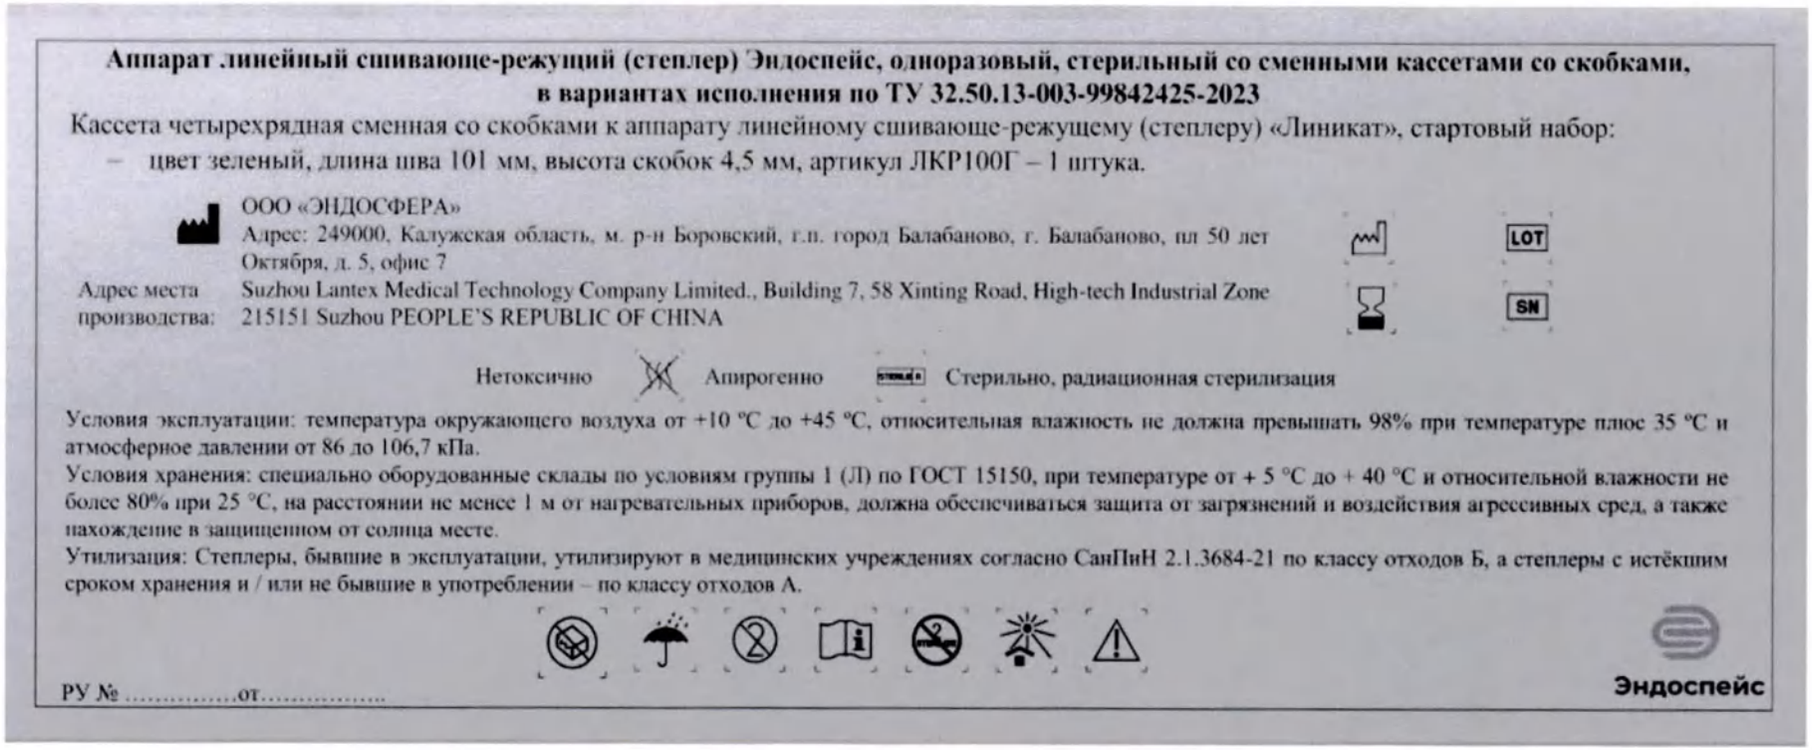

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 152А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

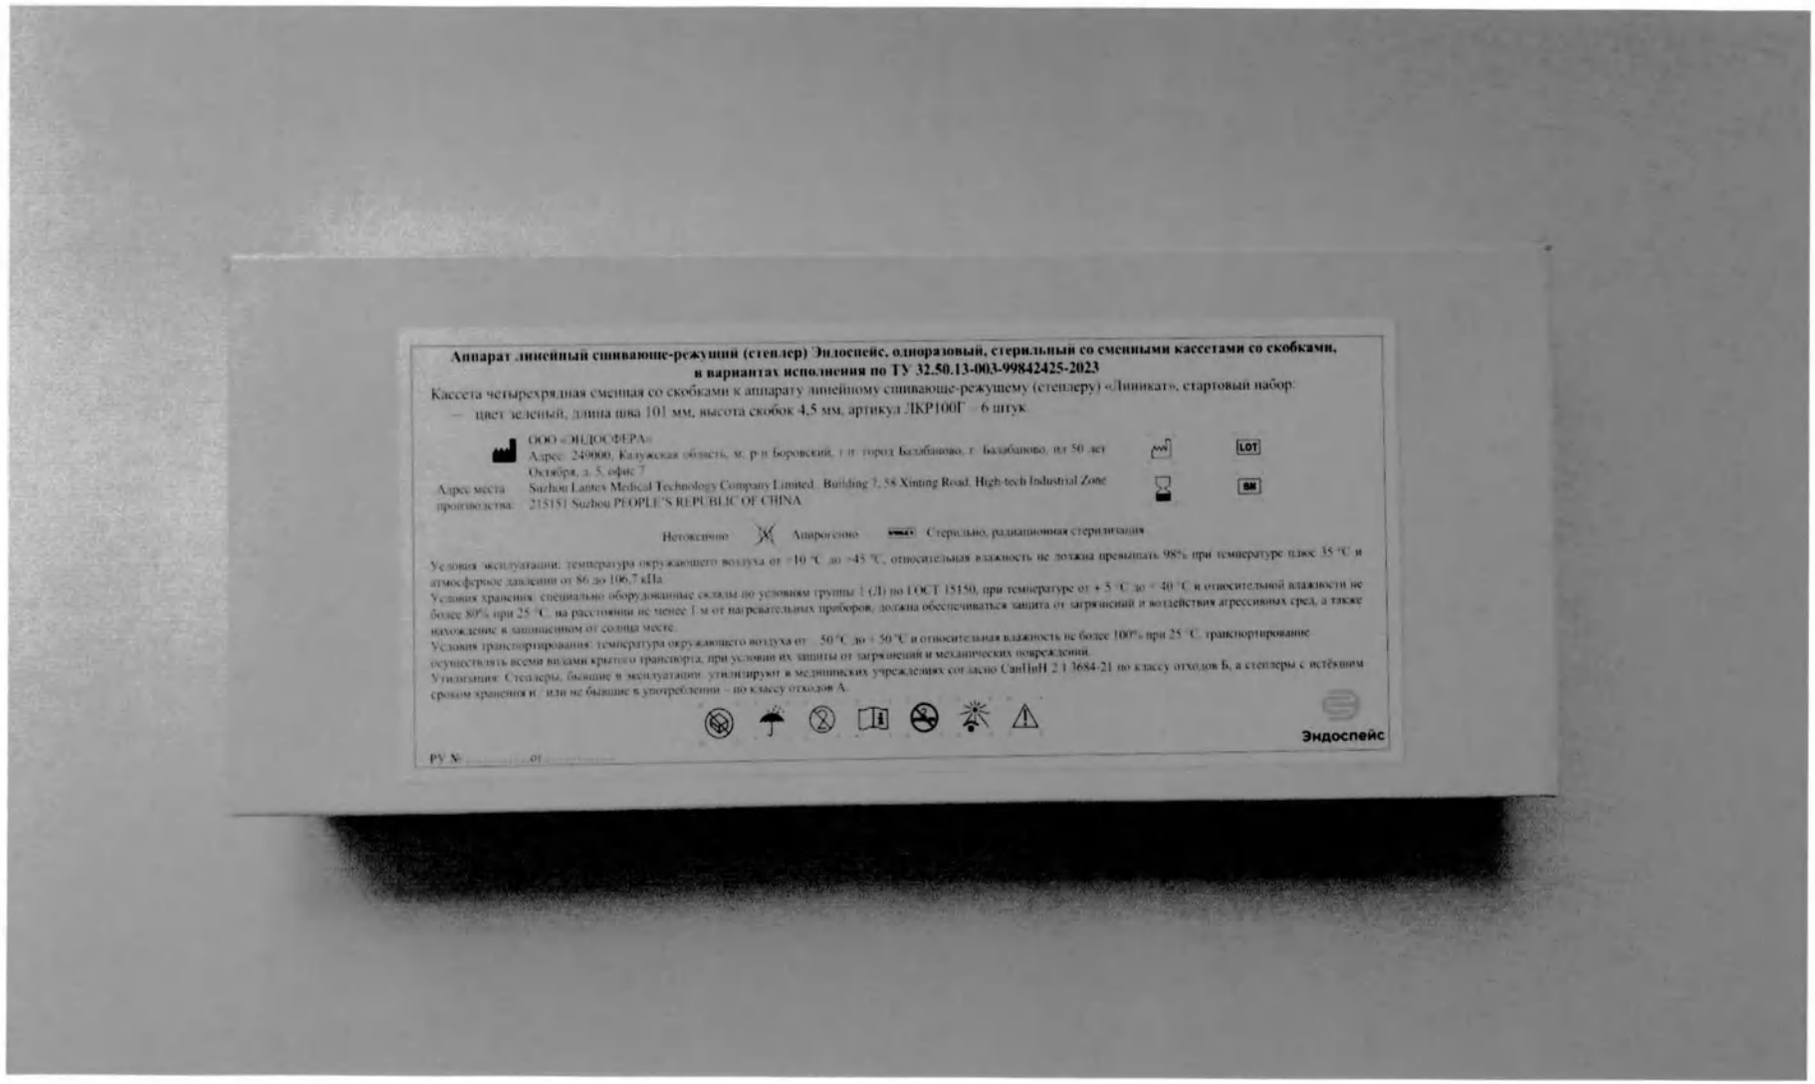

Рисунок 153 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

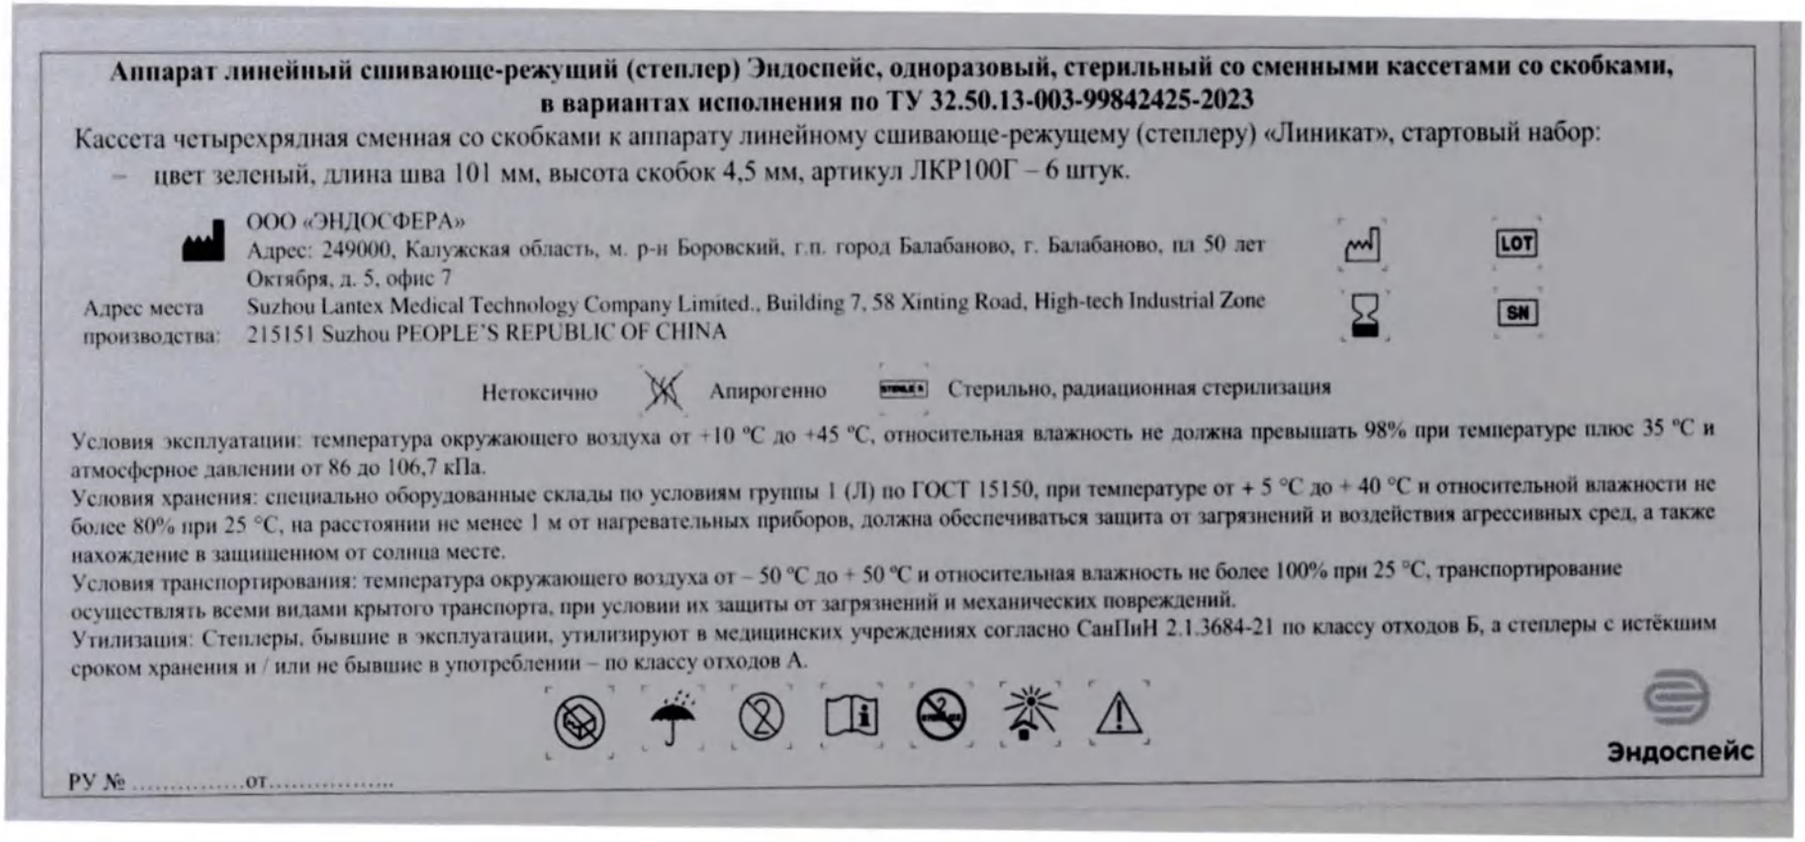

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 153А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

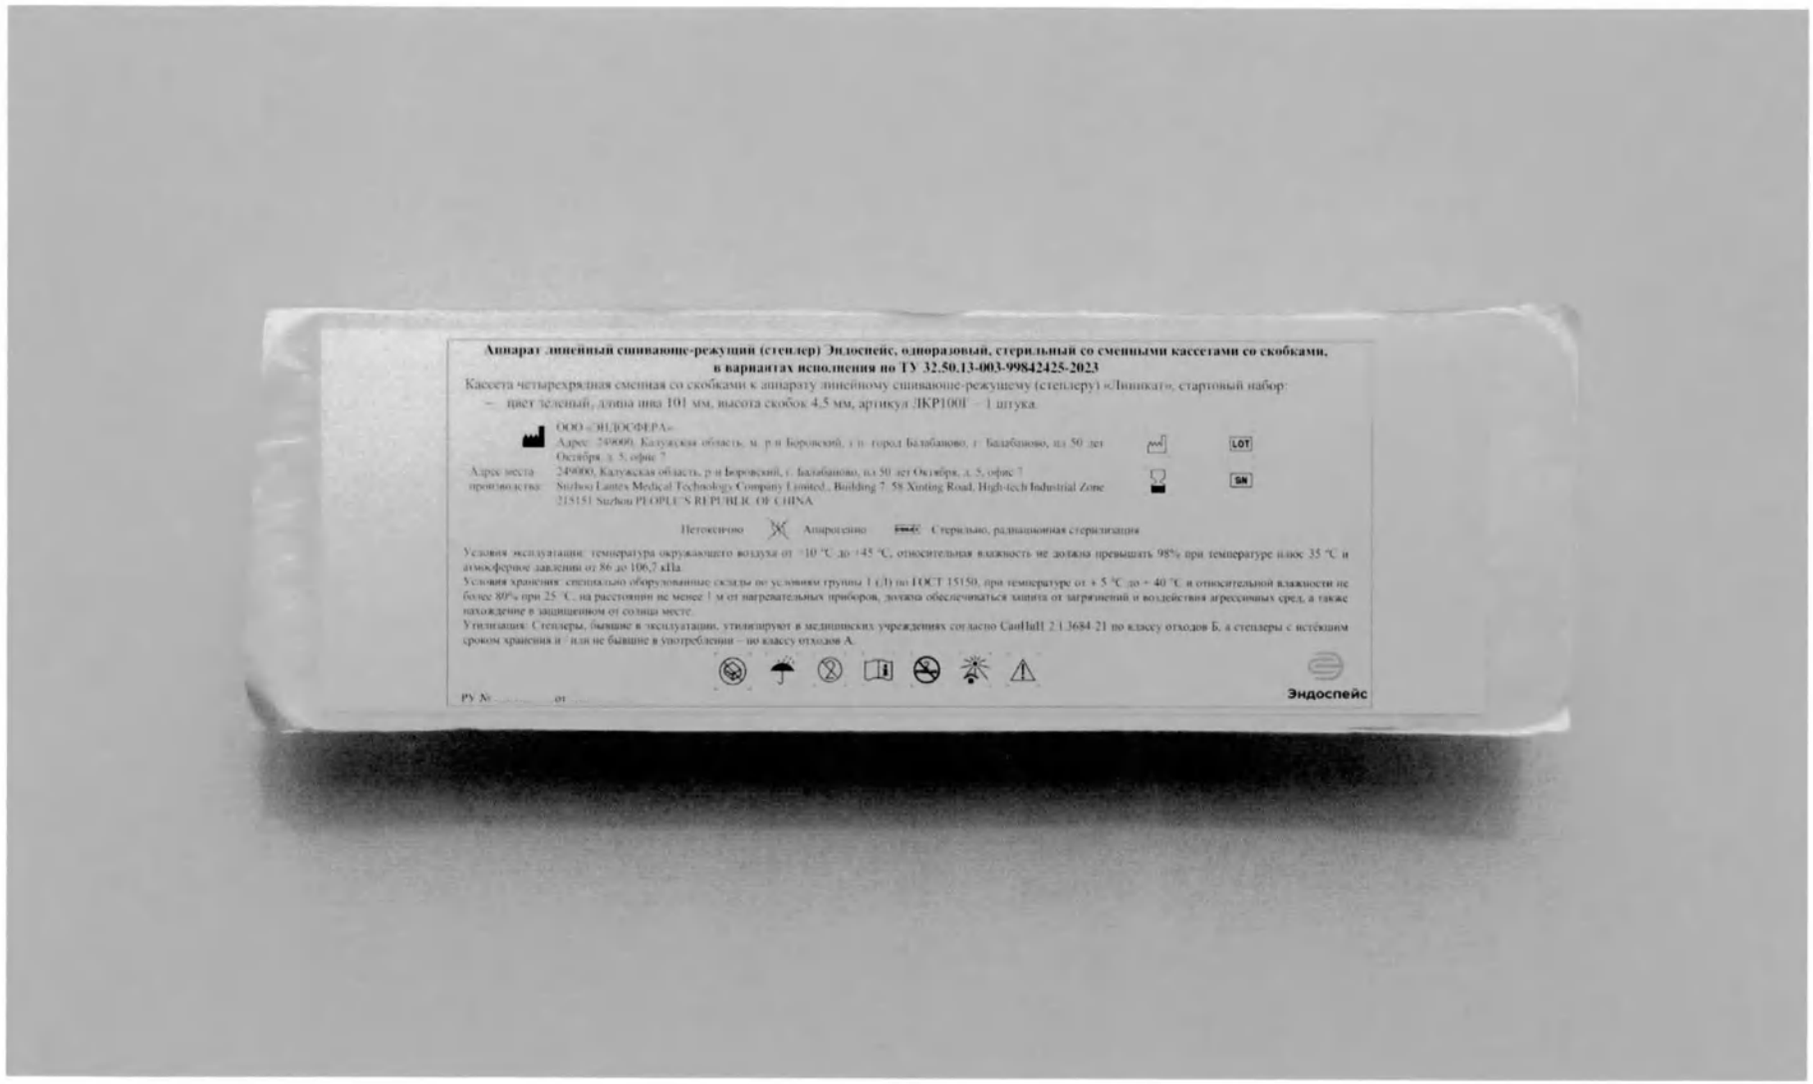

Рисунок 154 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

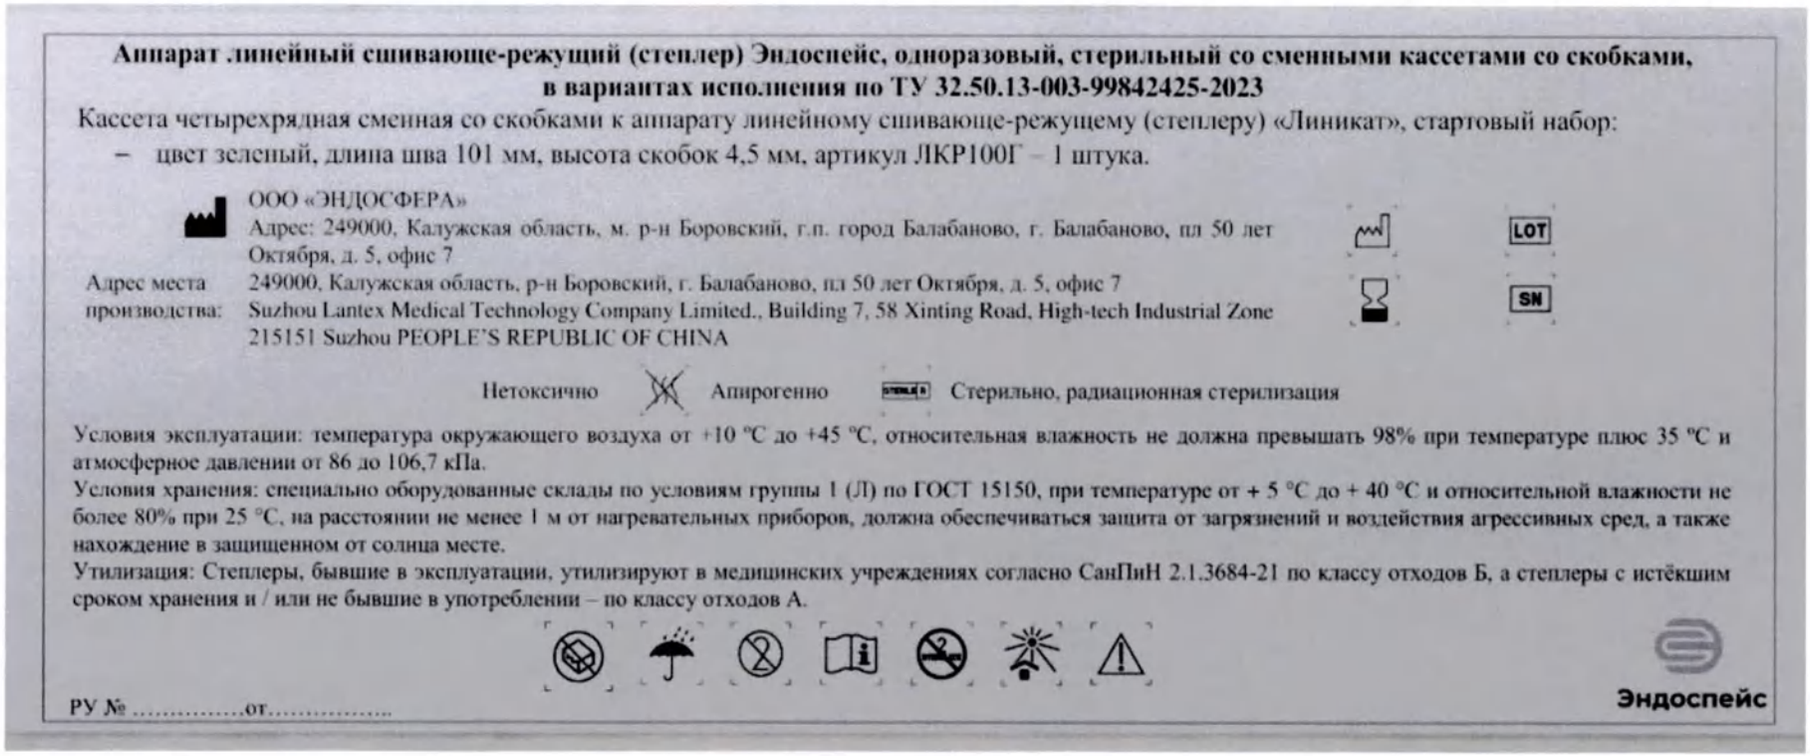

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 154А – Маркировка индивидуальной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

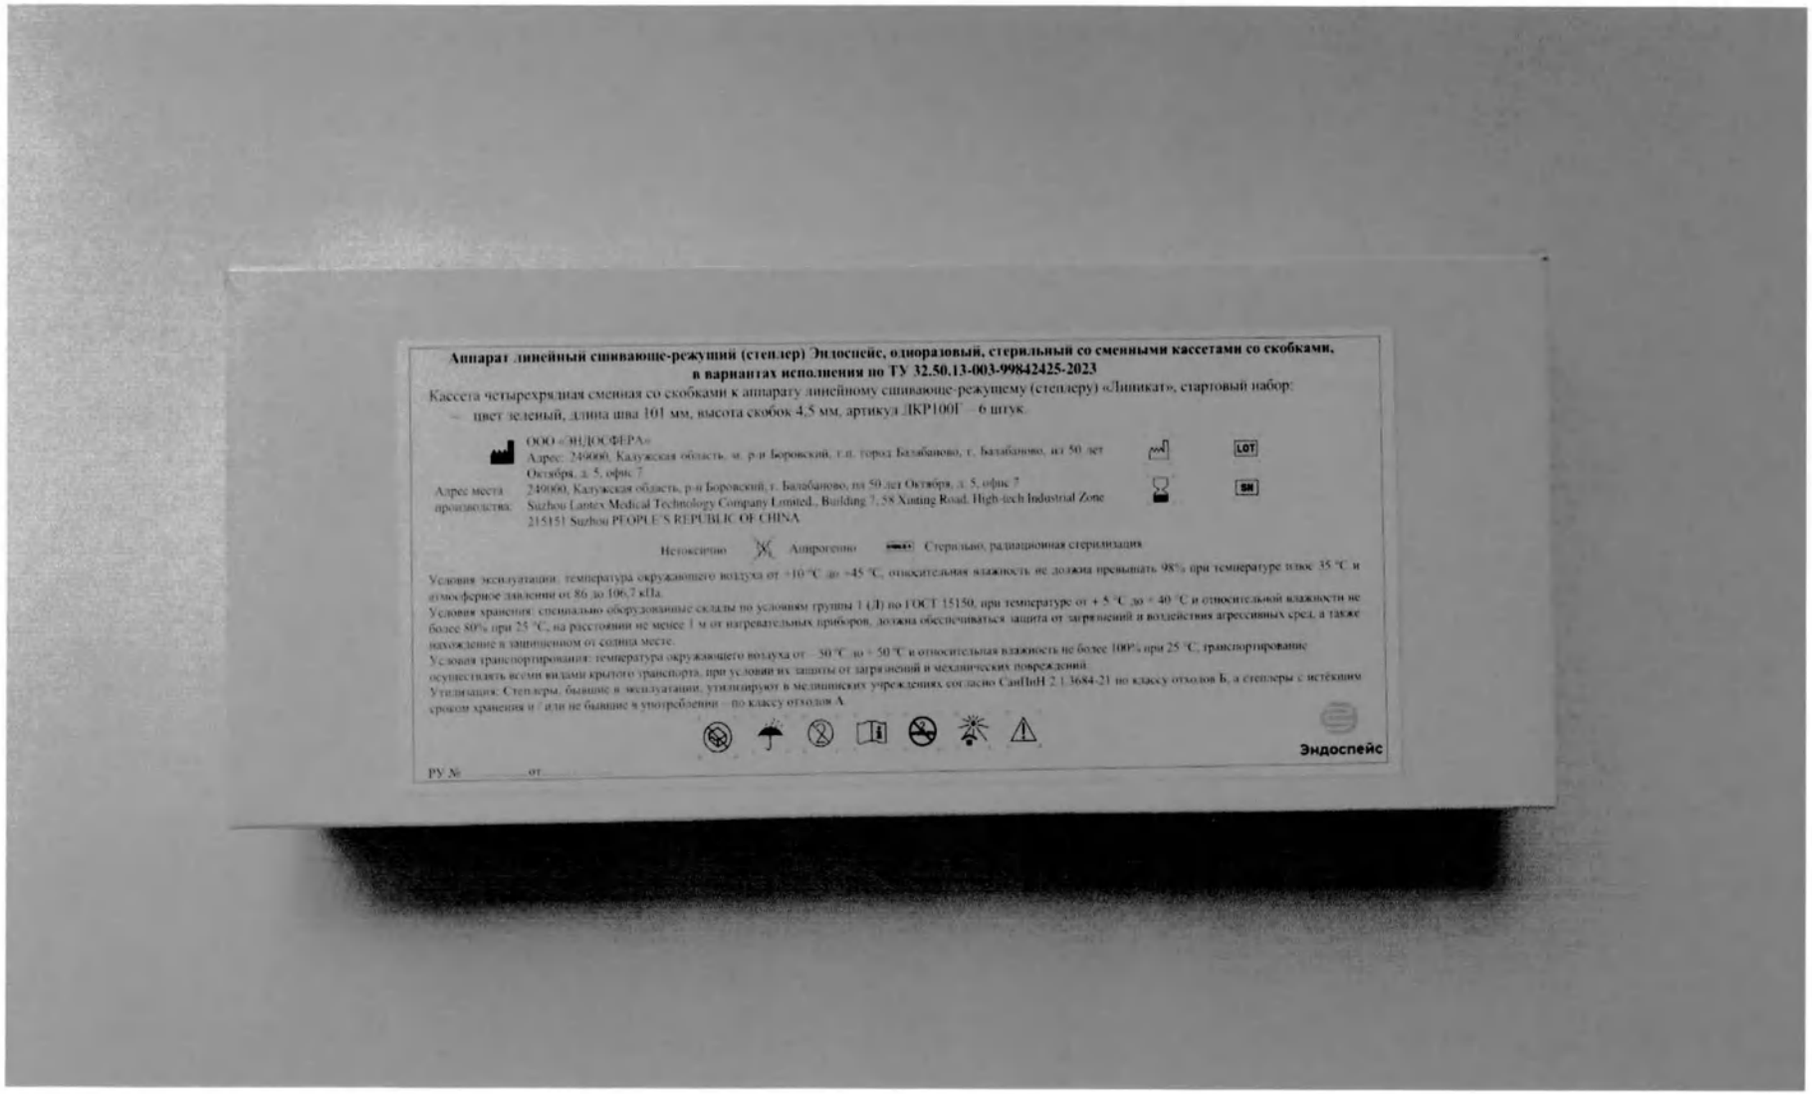

Рисунок 155 – Потребительская упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г – 6 штук.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Эндоспейс

РУ № .....от.....

Рисунок 155А – Маркировка потребительской упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 156 – Транспортная упаковка с маркировкой Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

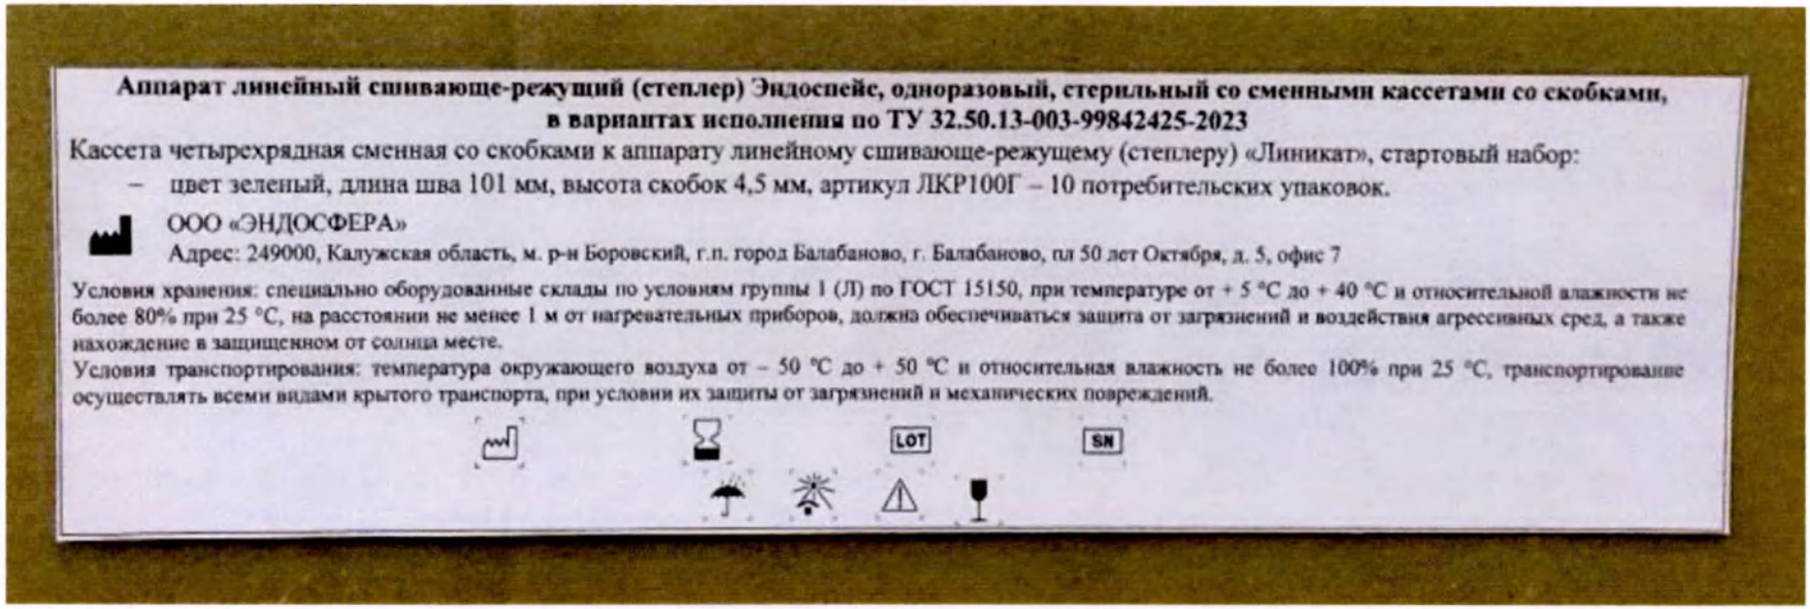

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Кассета четырехрядная сменная со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г – 10 потребительских упаковок.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 156А – Маркировка транспортной упаковки Кассеты четырехрядной сменной со скобками к аппарату линейному сшивающе-режущему (степлеру) «Линикат», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 101 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ЛКР100Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

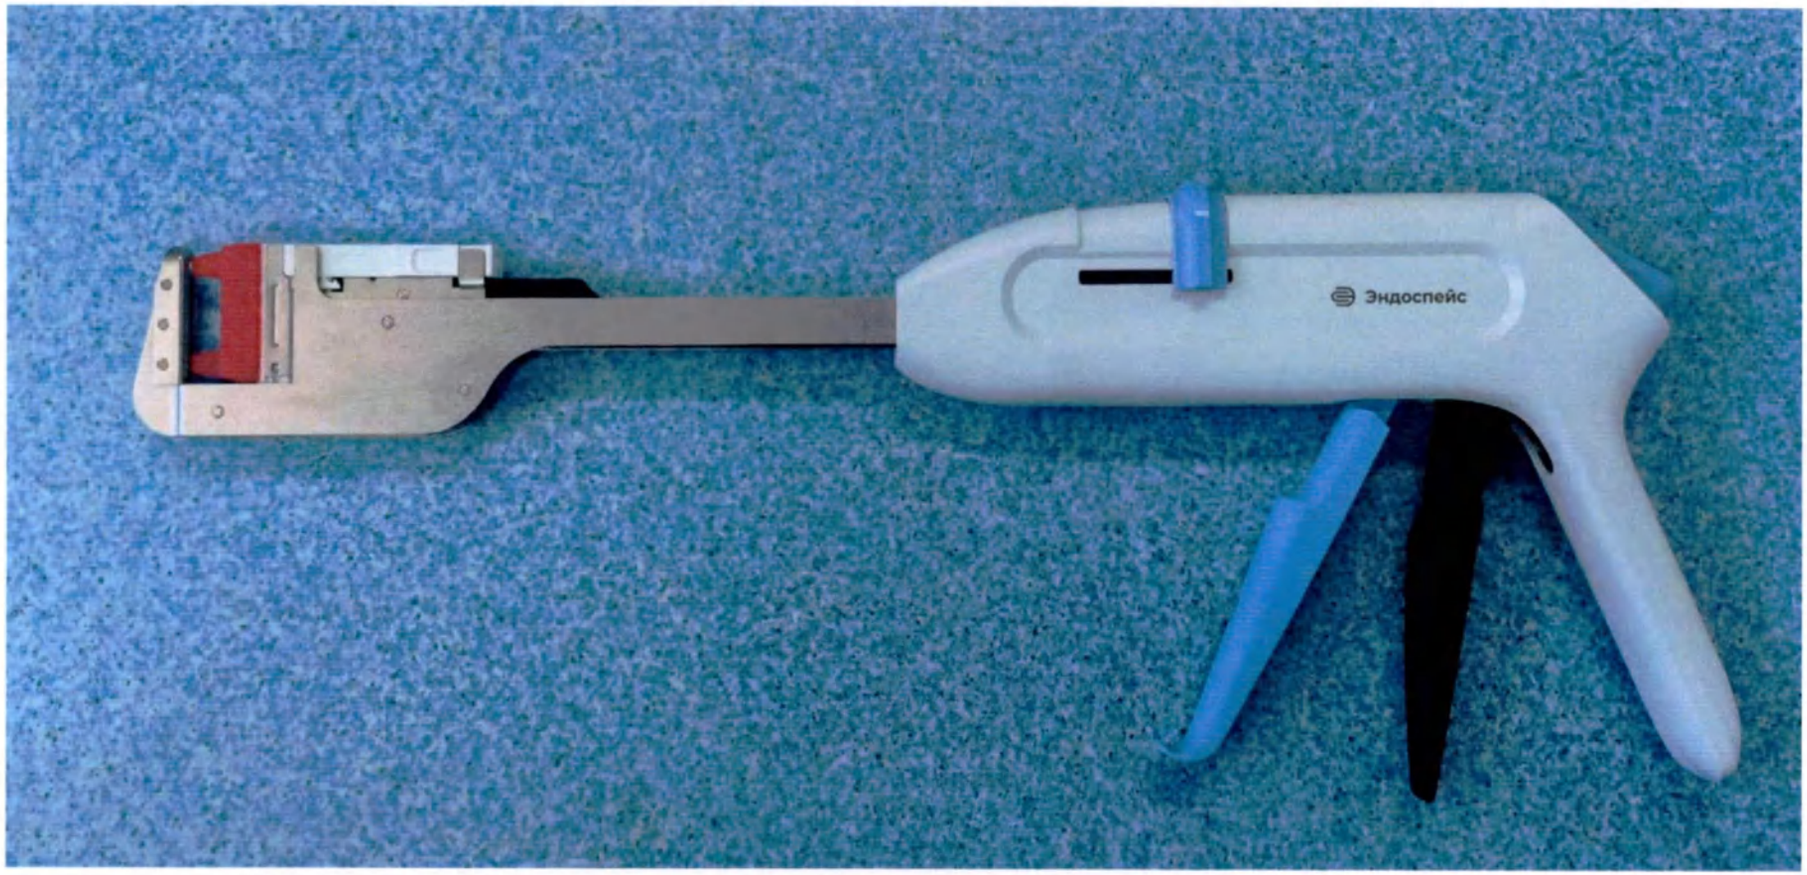

Рисунок 157 – Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 158 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

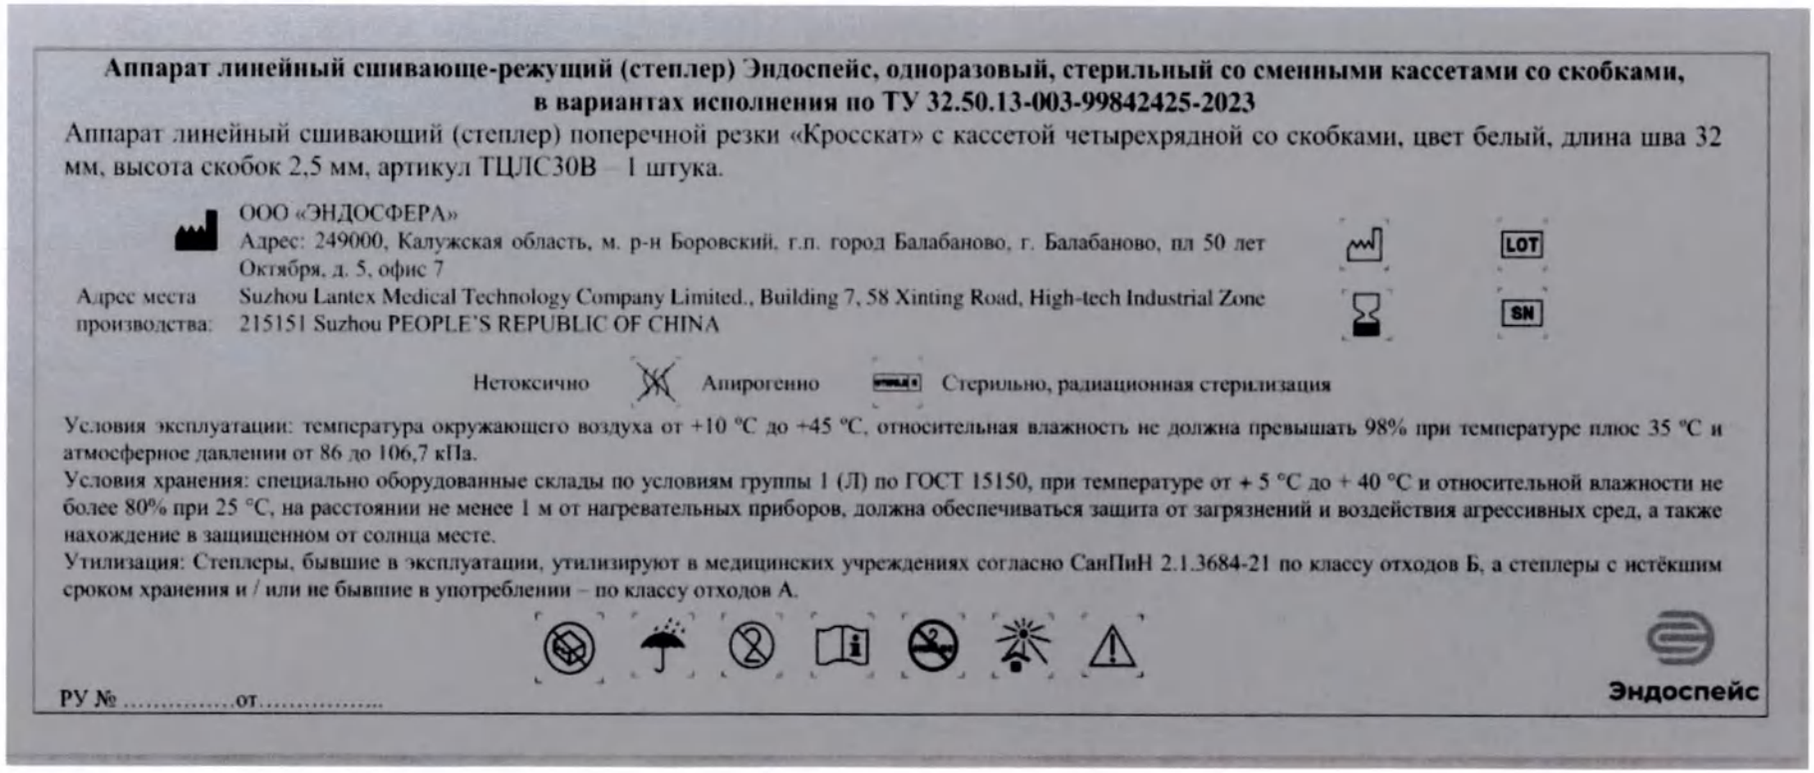

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 158А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 159 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

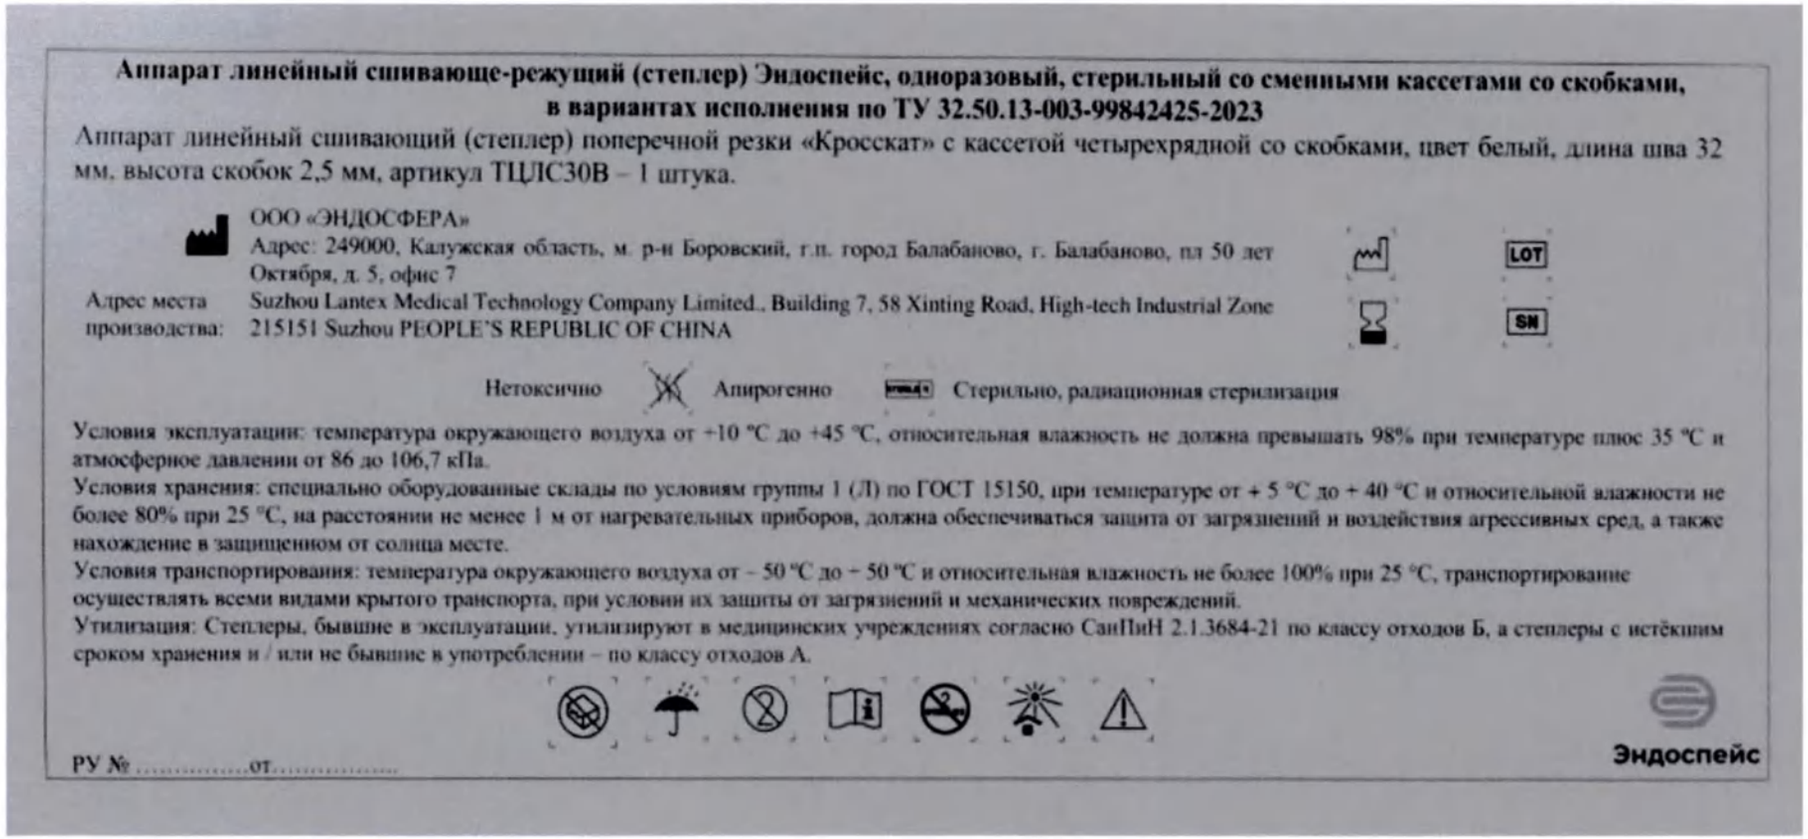

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 159А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 160 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

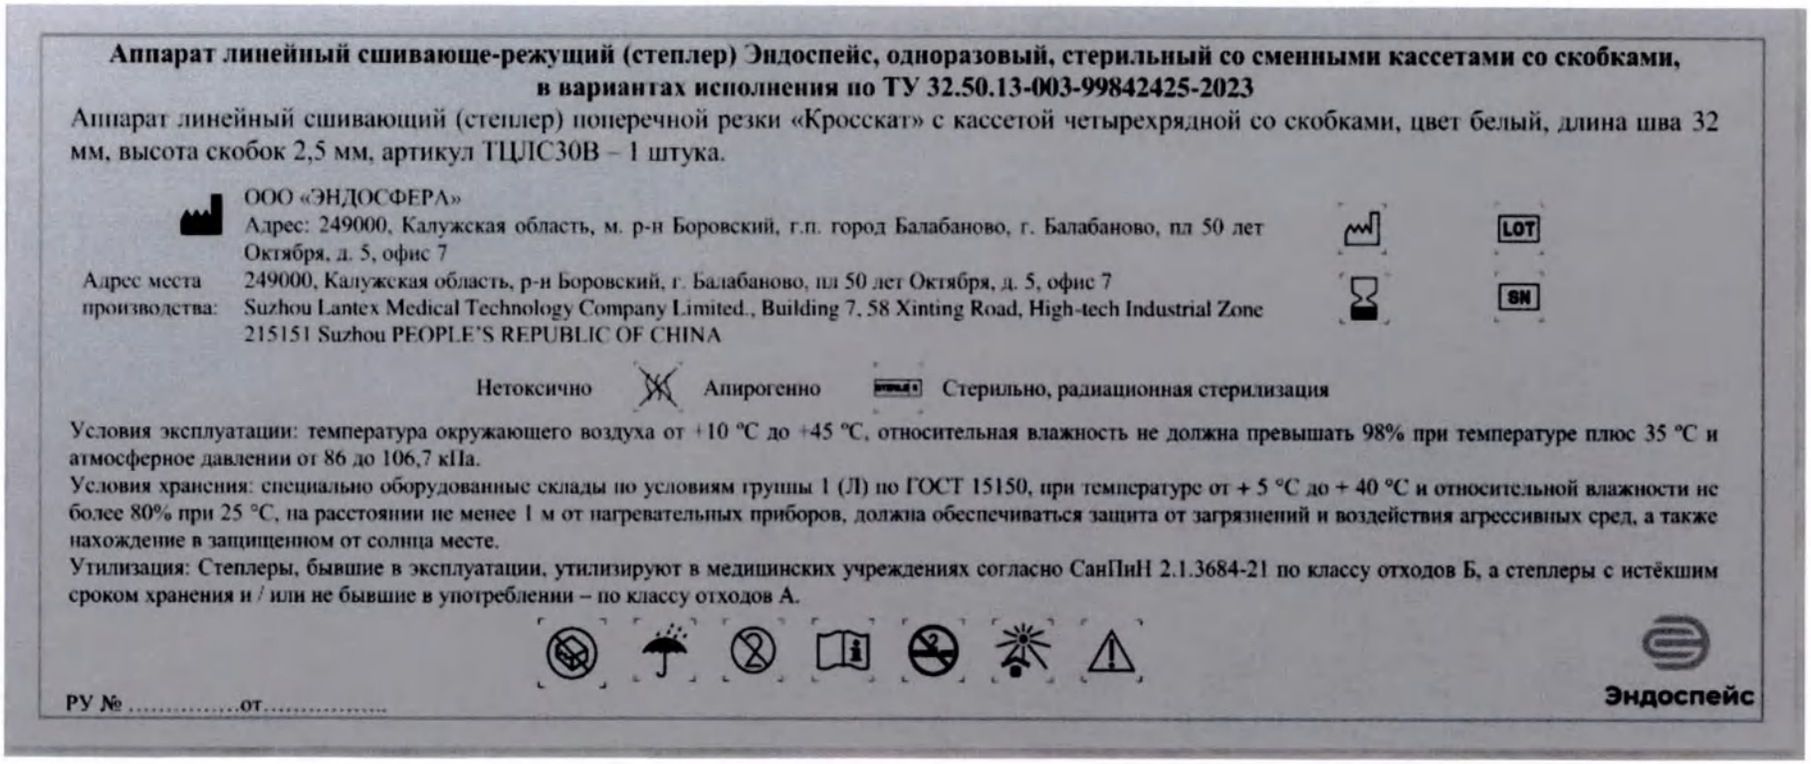

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 160А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

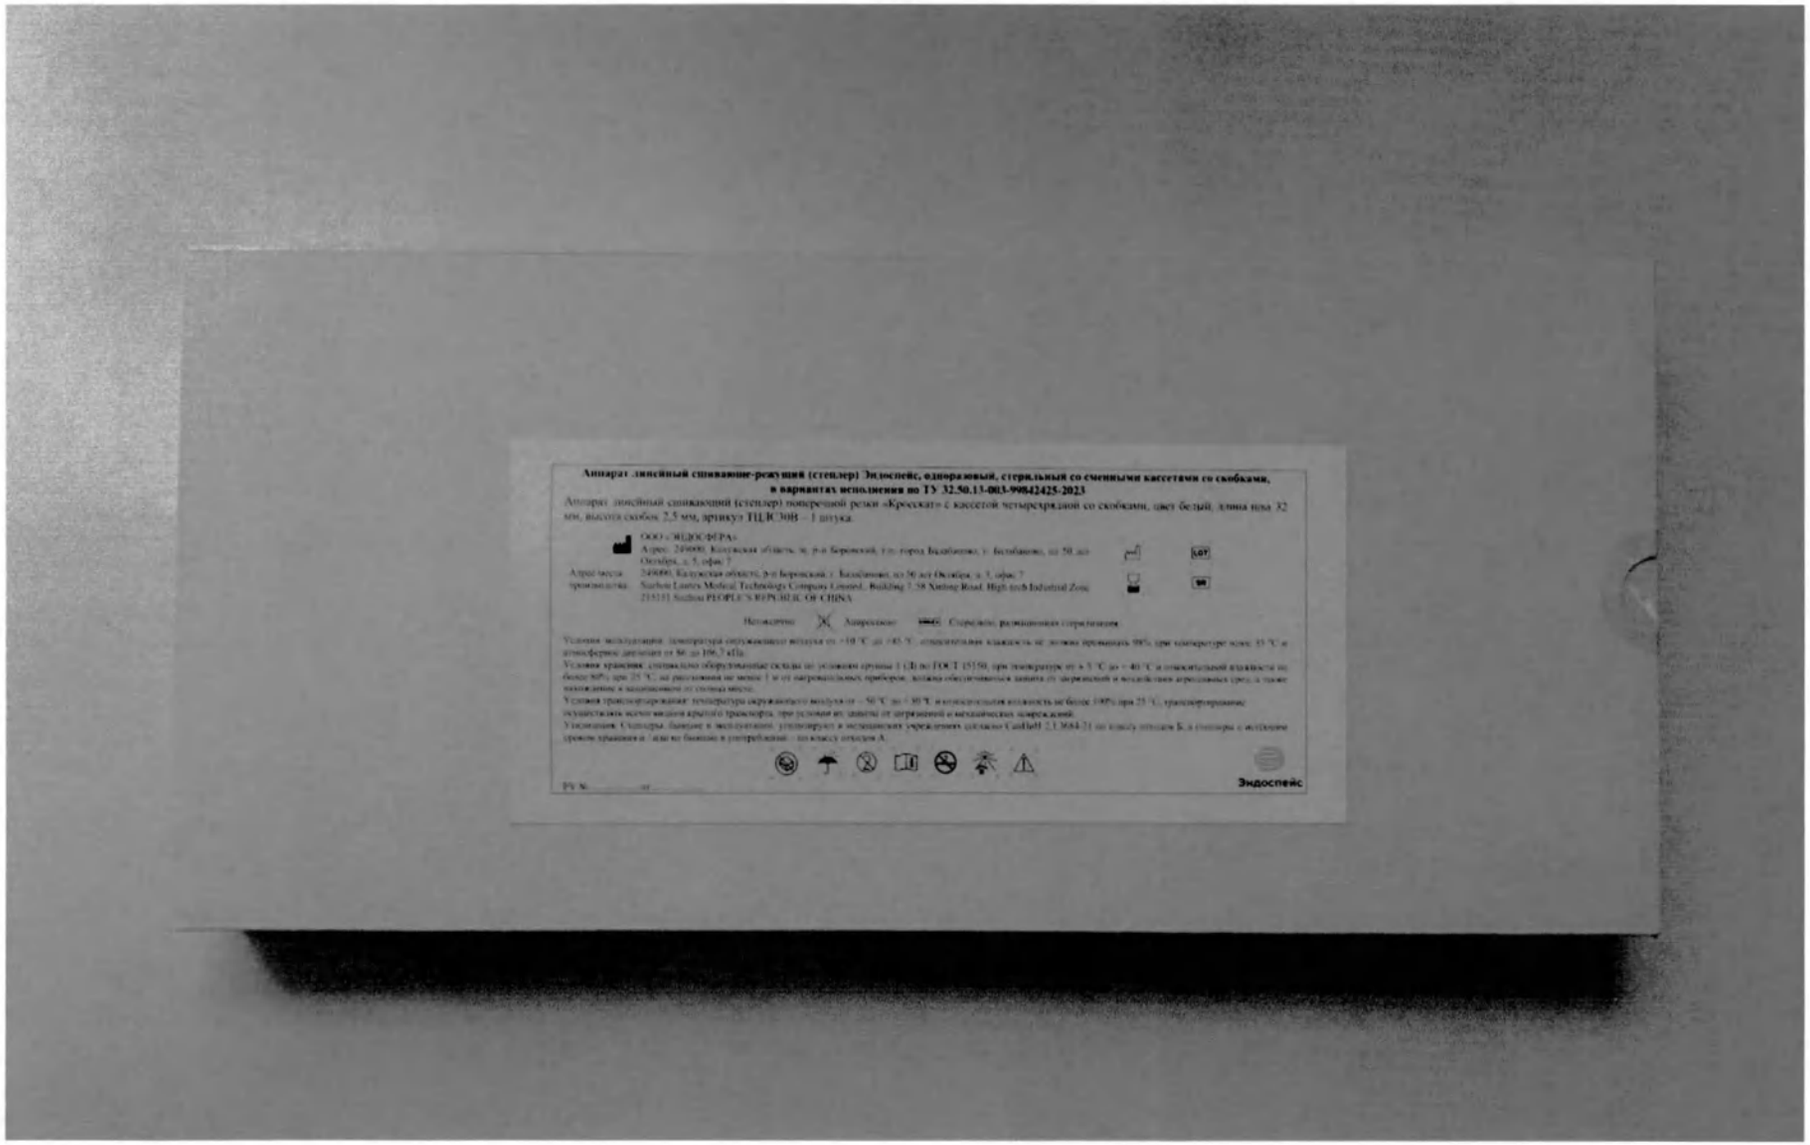

Рисунок 161 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

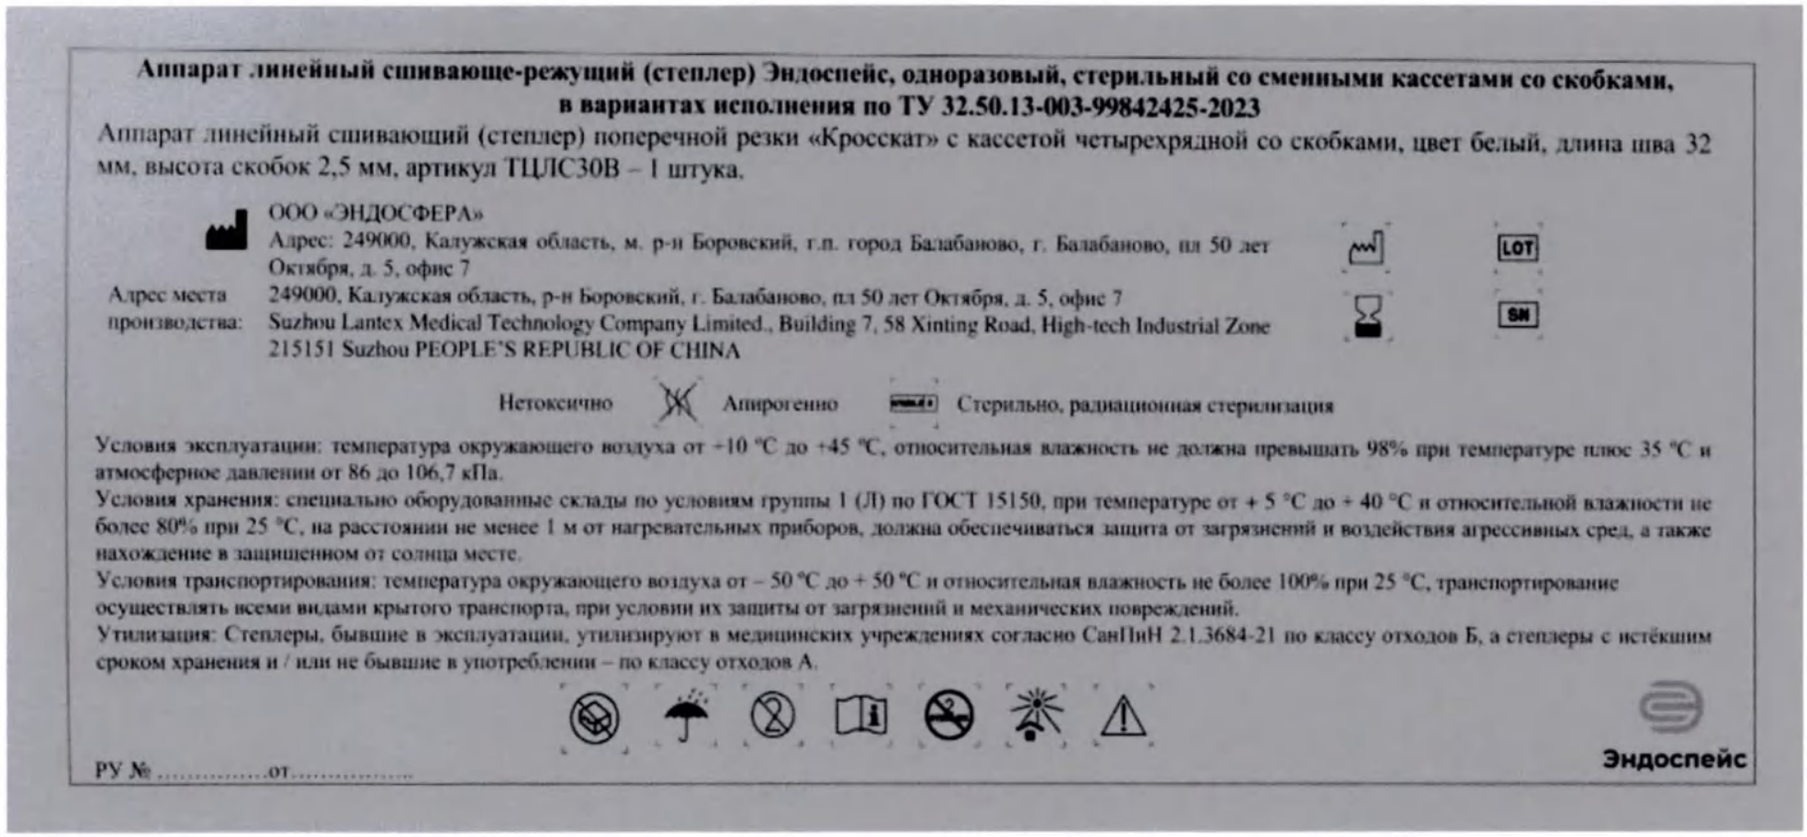

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 161А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

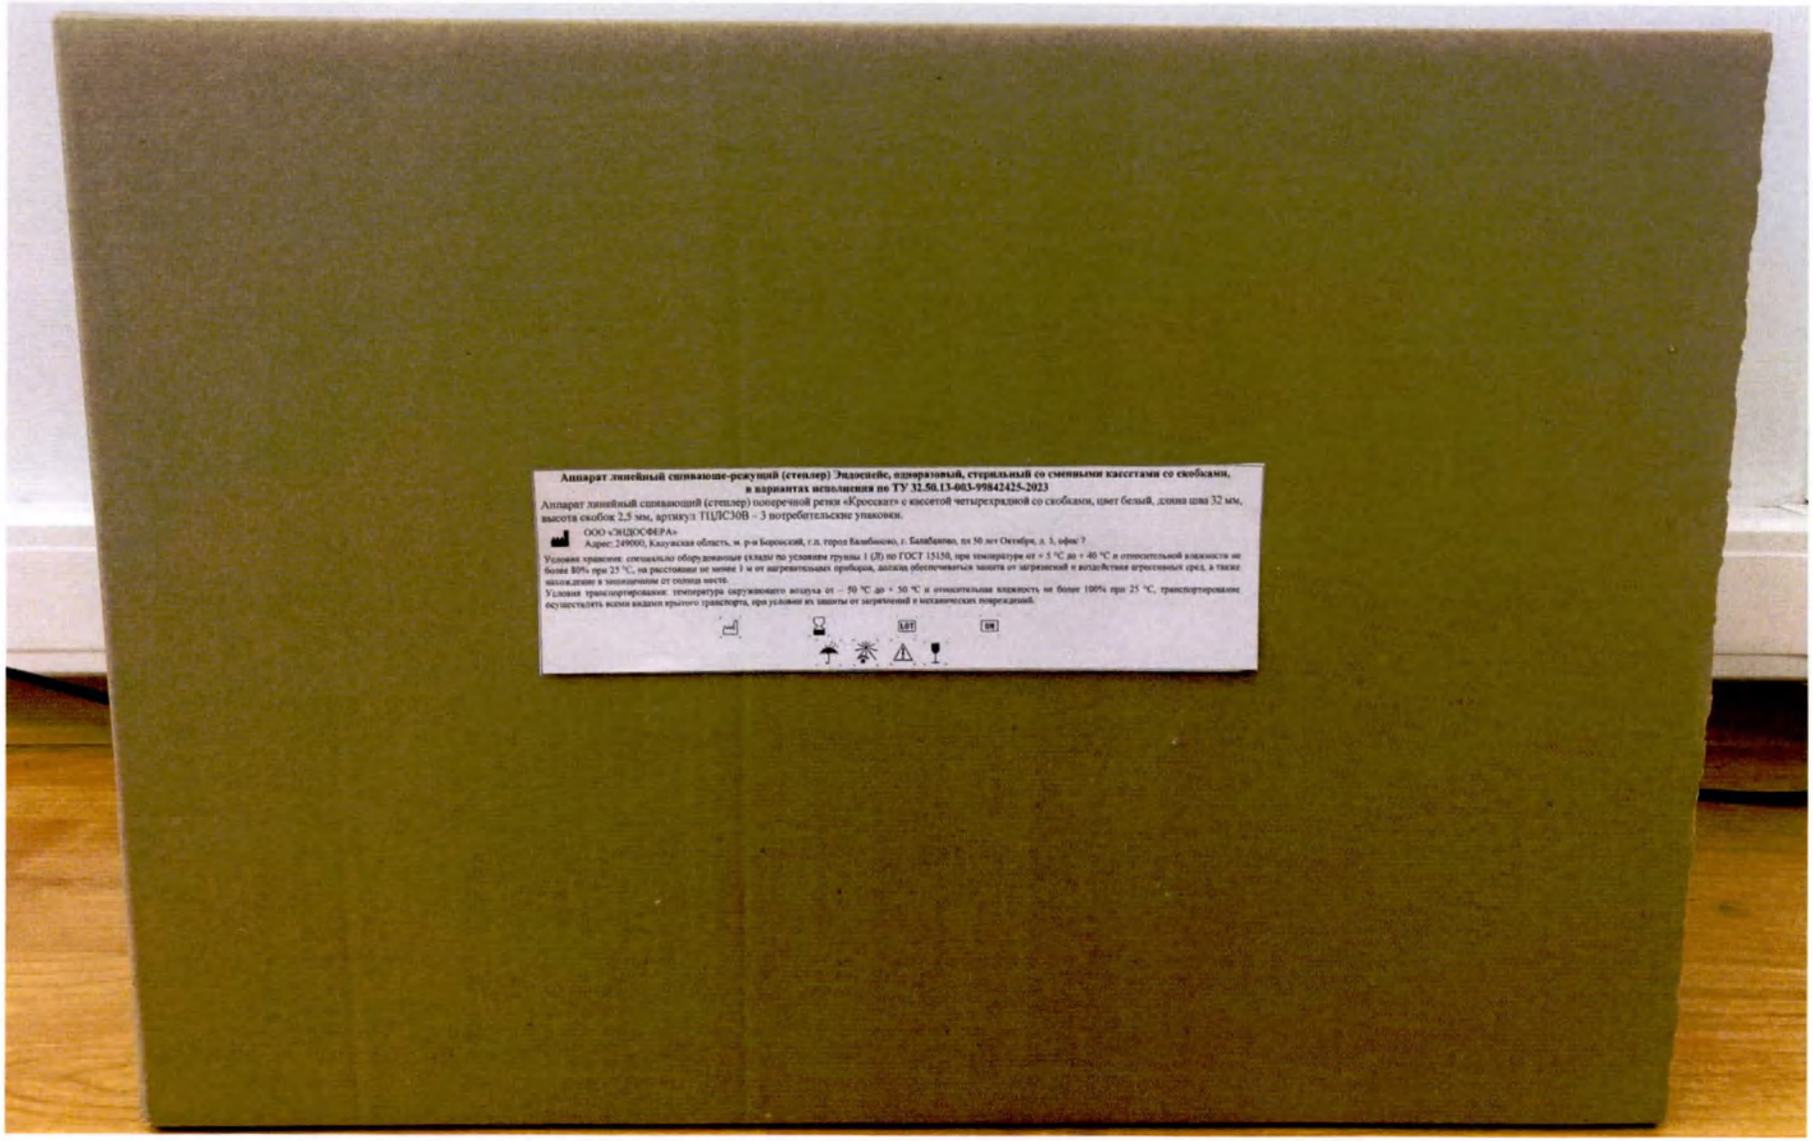

Рисунок 162 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

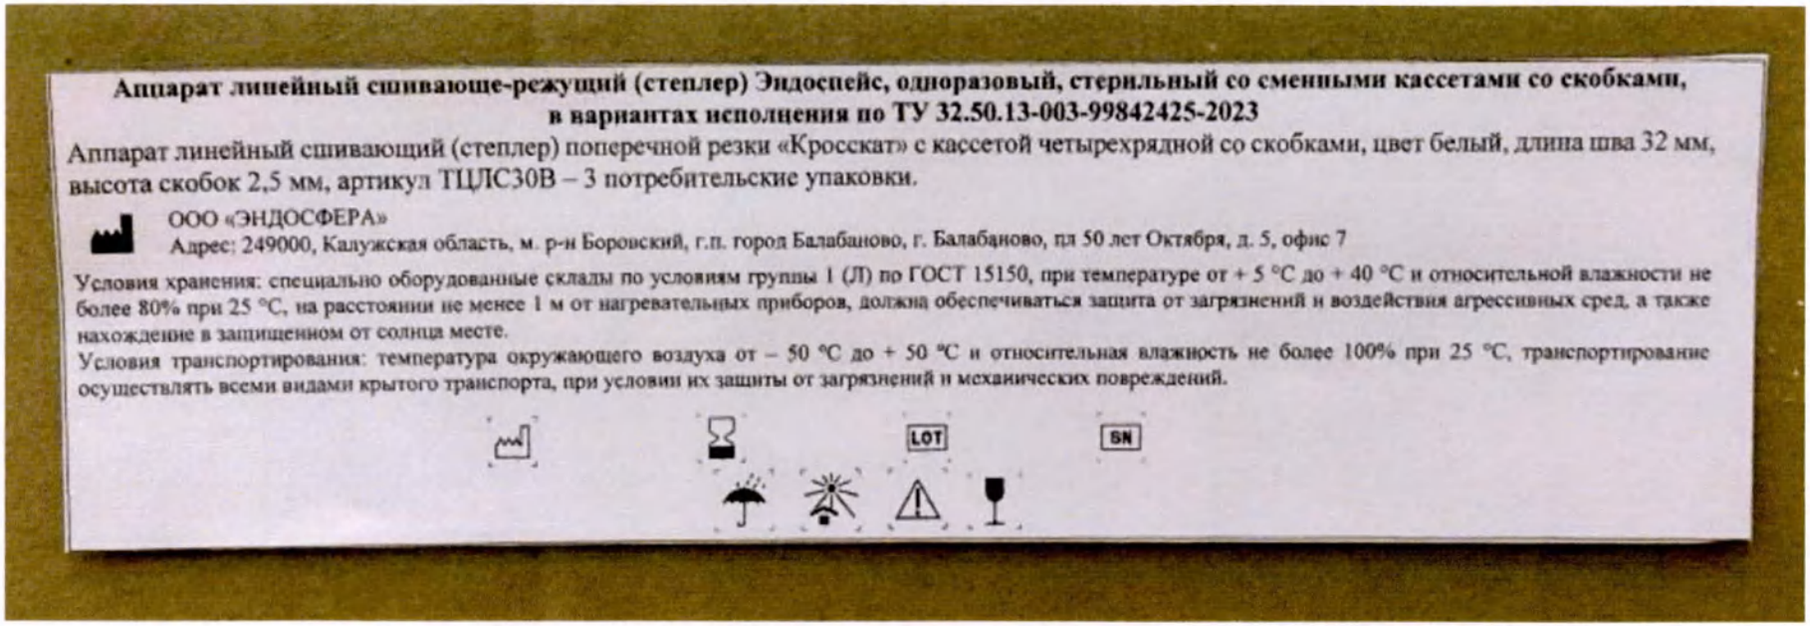

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

LOT SN

Рисунок 162А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС30В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

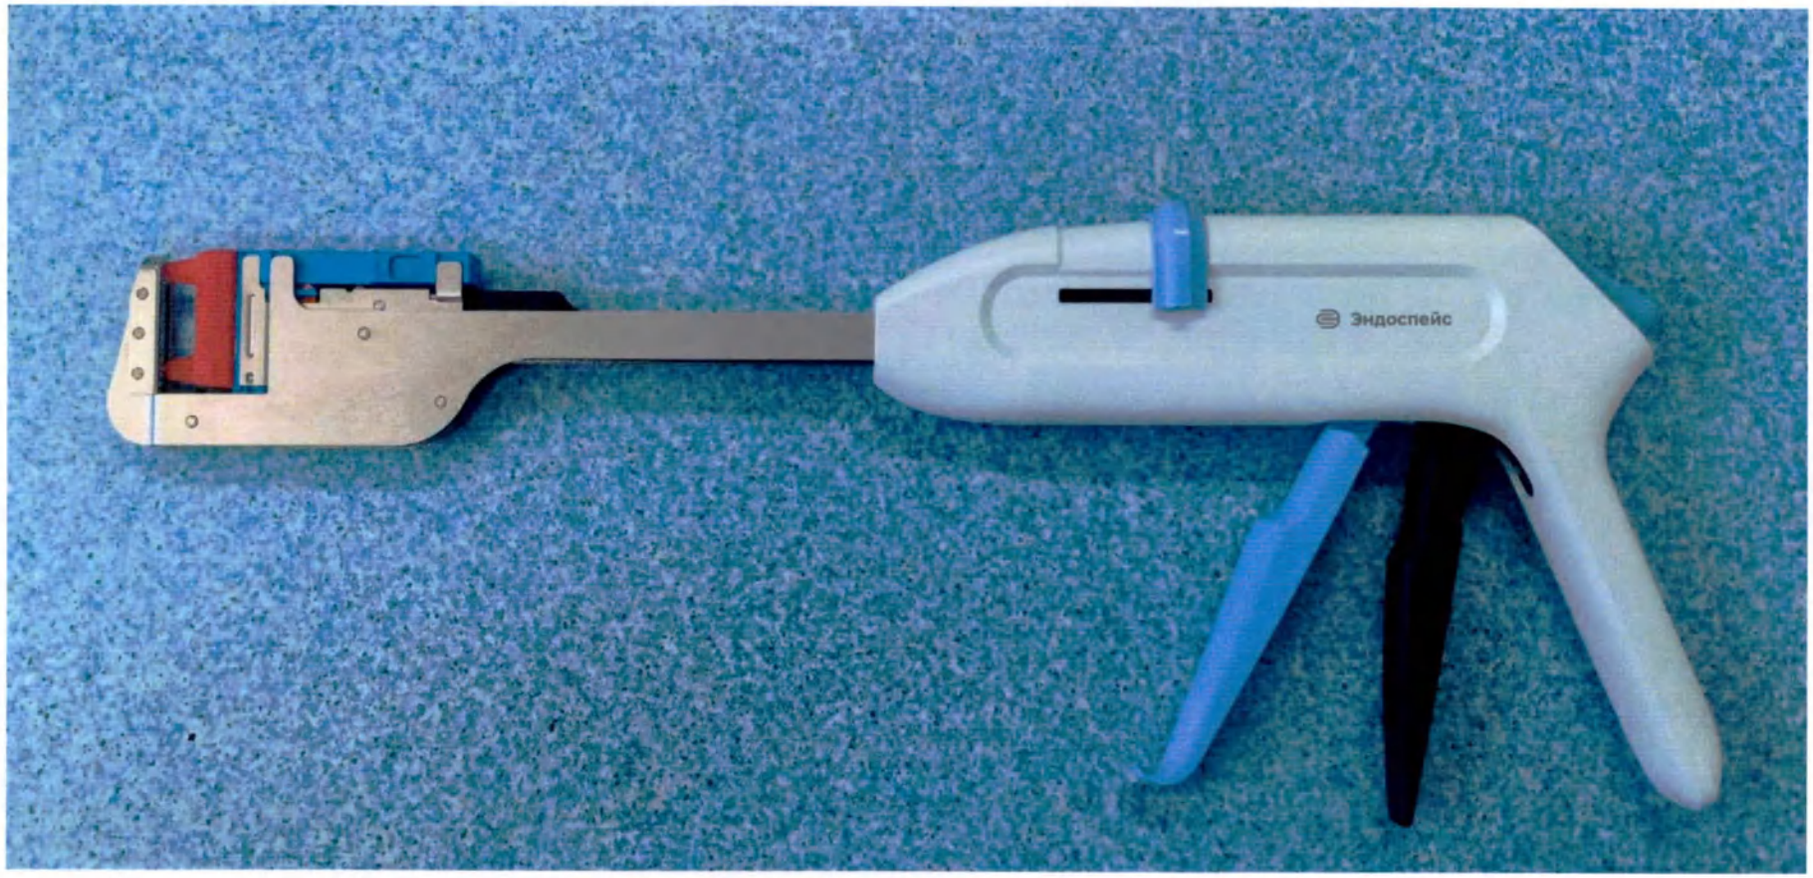

Рисунок 163 – Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 164 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 164А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

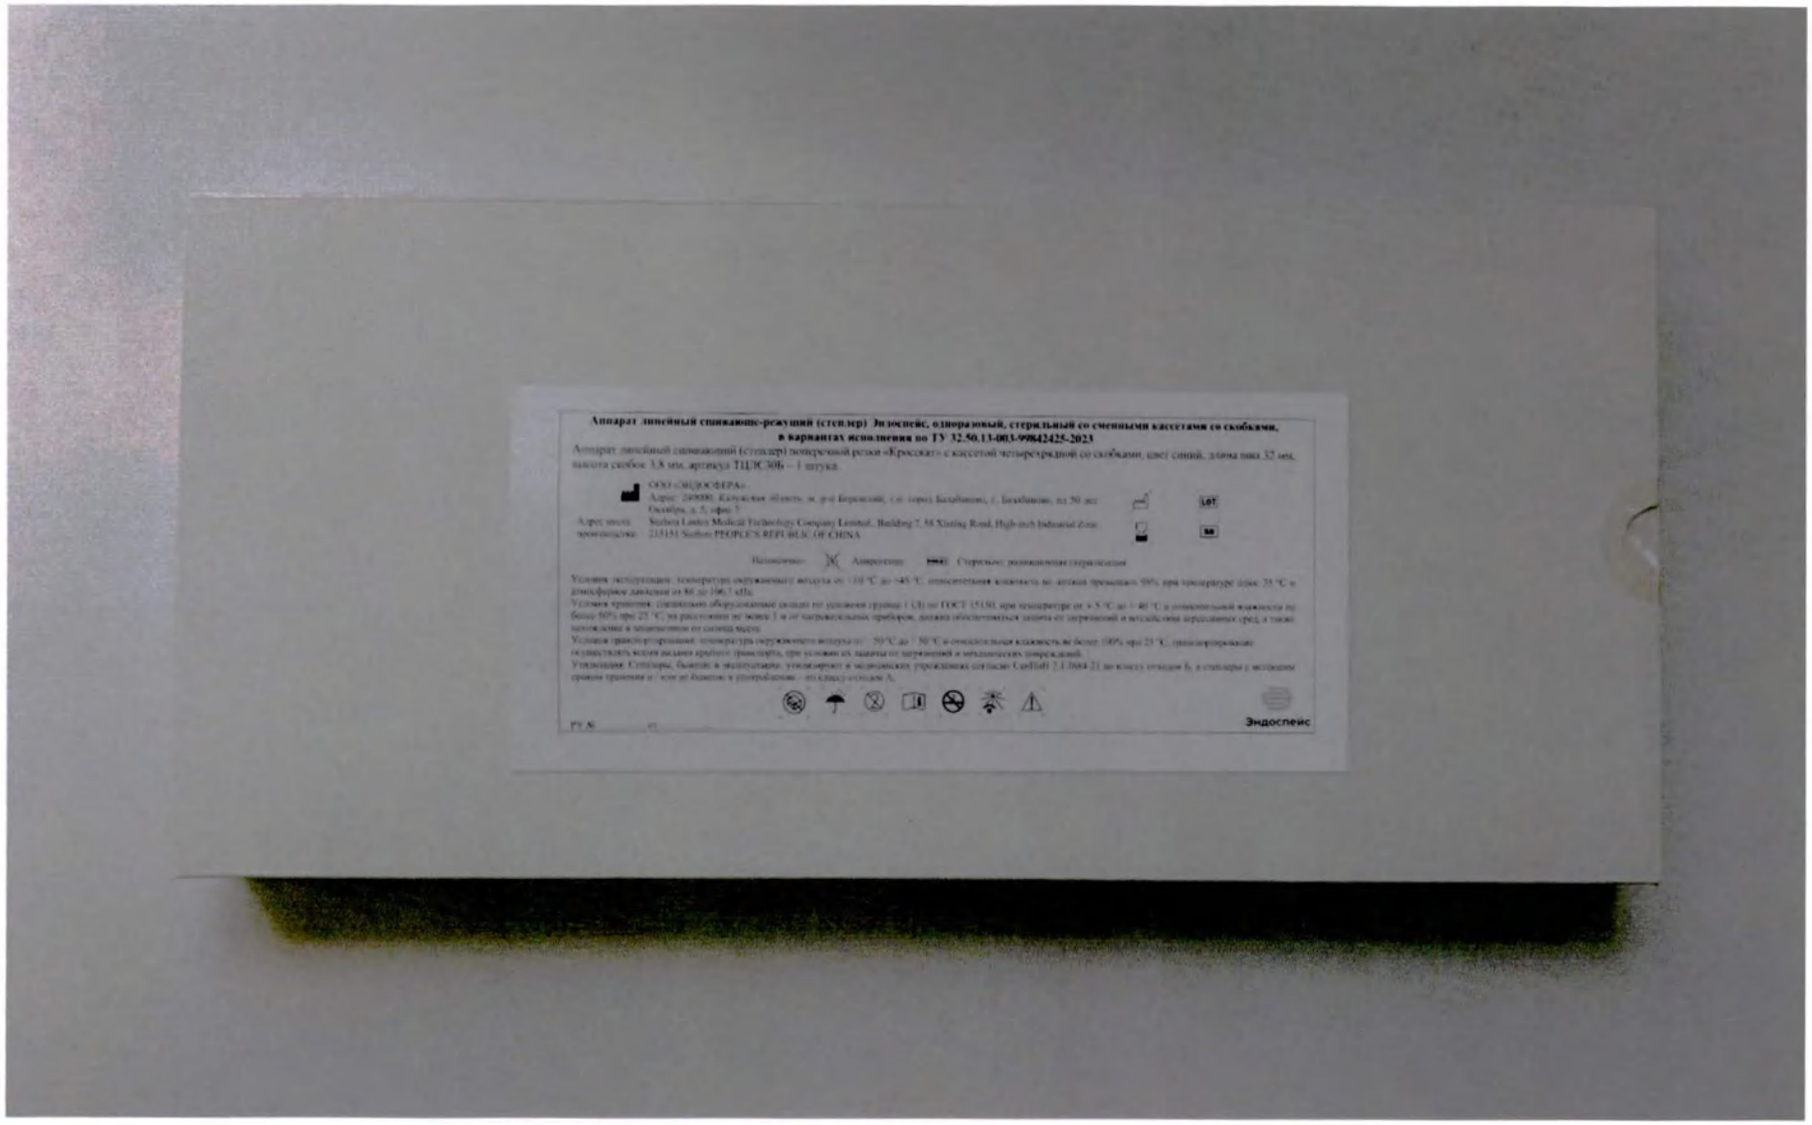

Рисунок 165 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

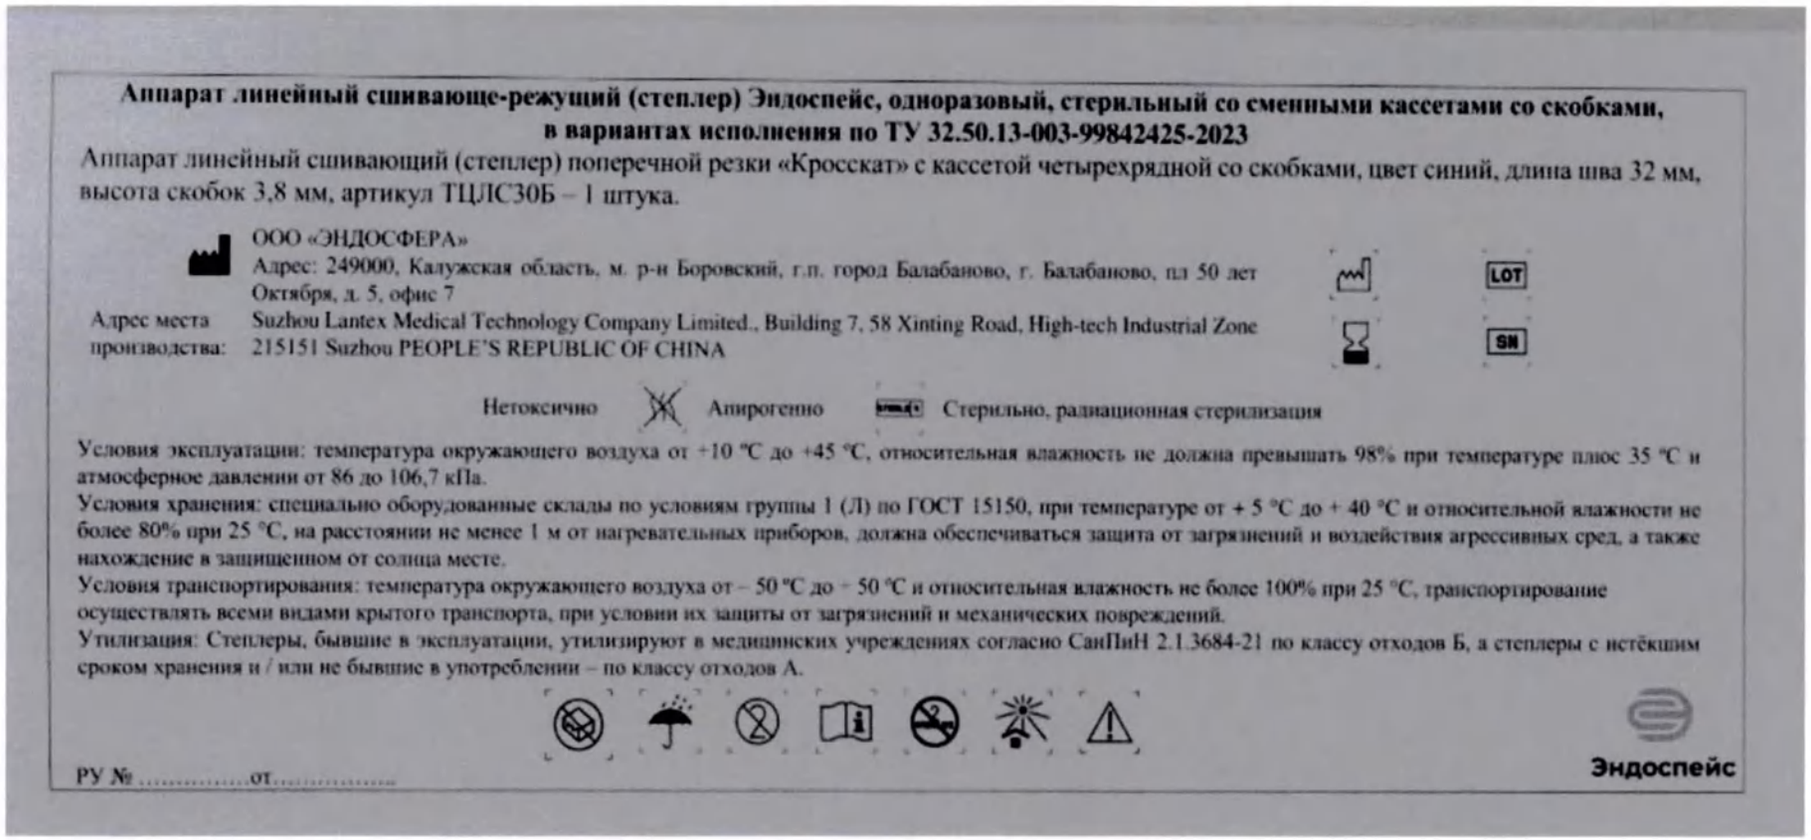

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 165А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 166 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 166А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 167 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 167А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 168 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

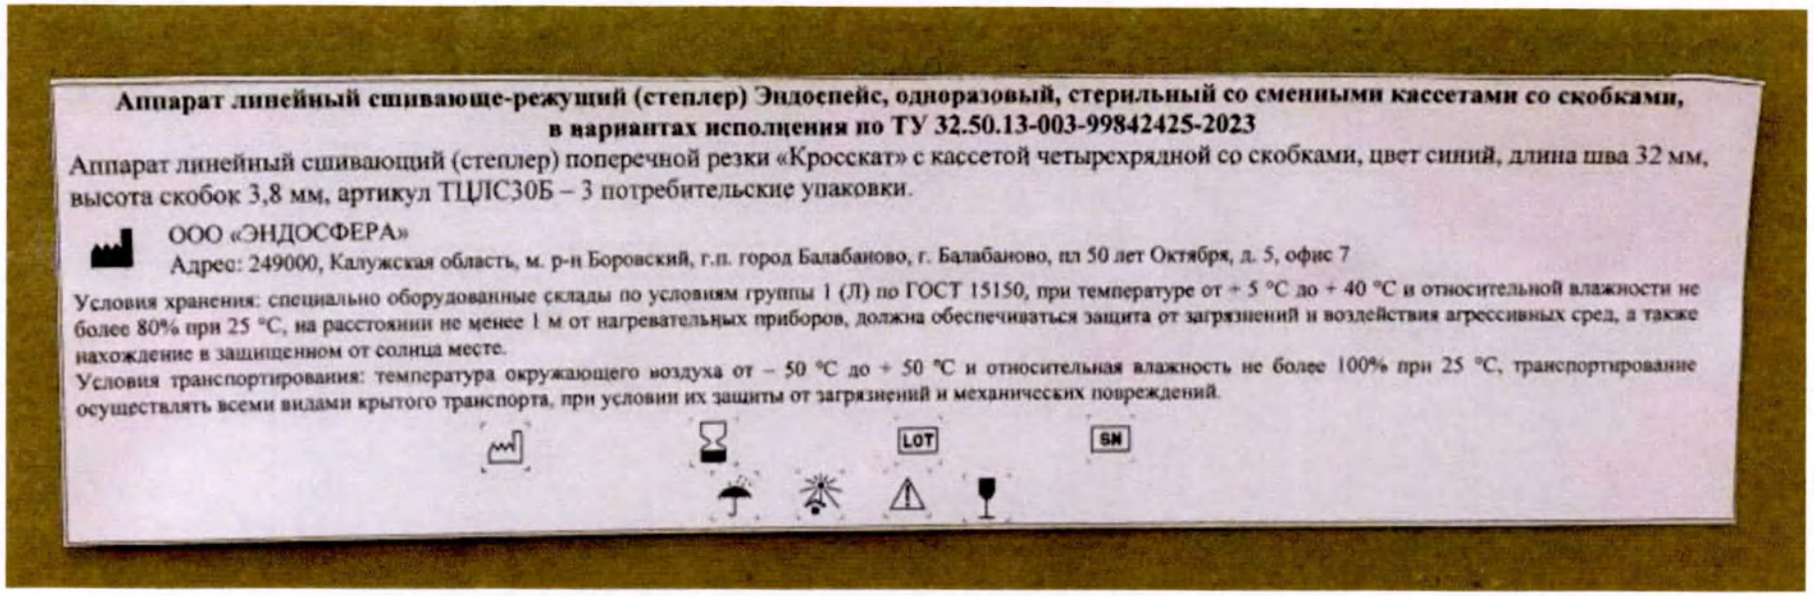

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 168А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС30Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

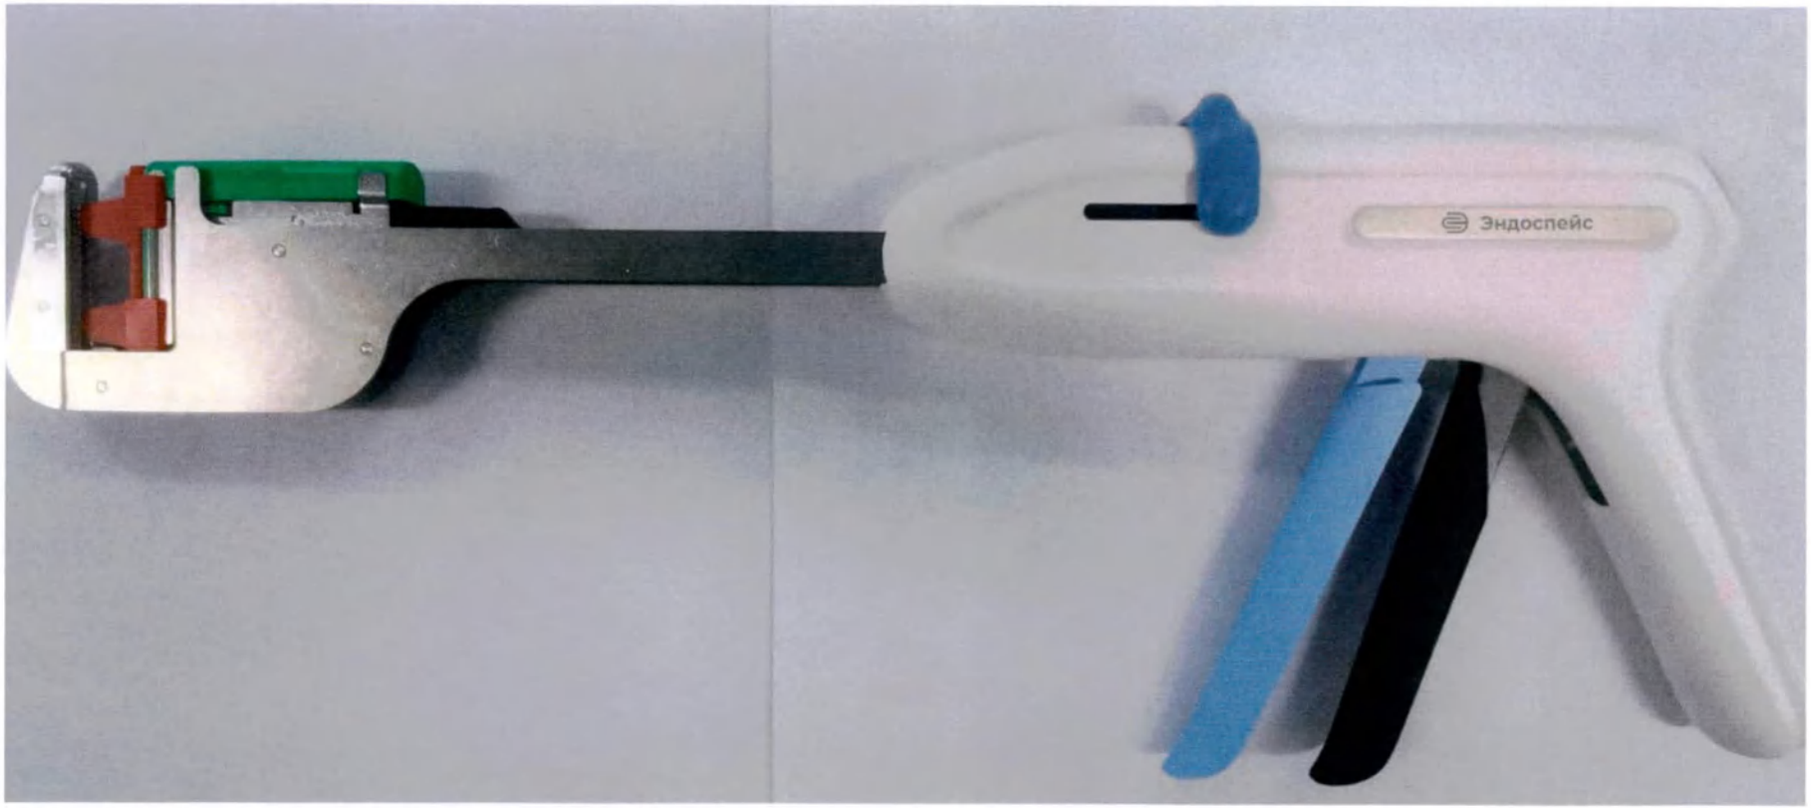

Рисунок 169 – Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 170 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 170А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

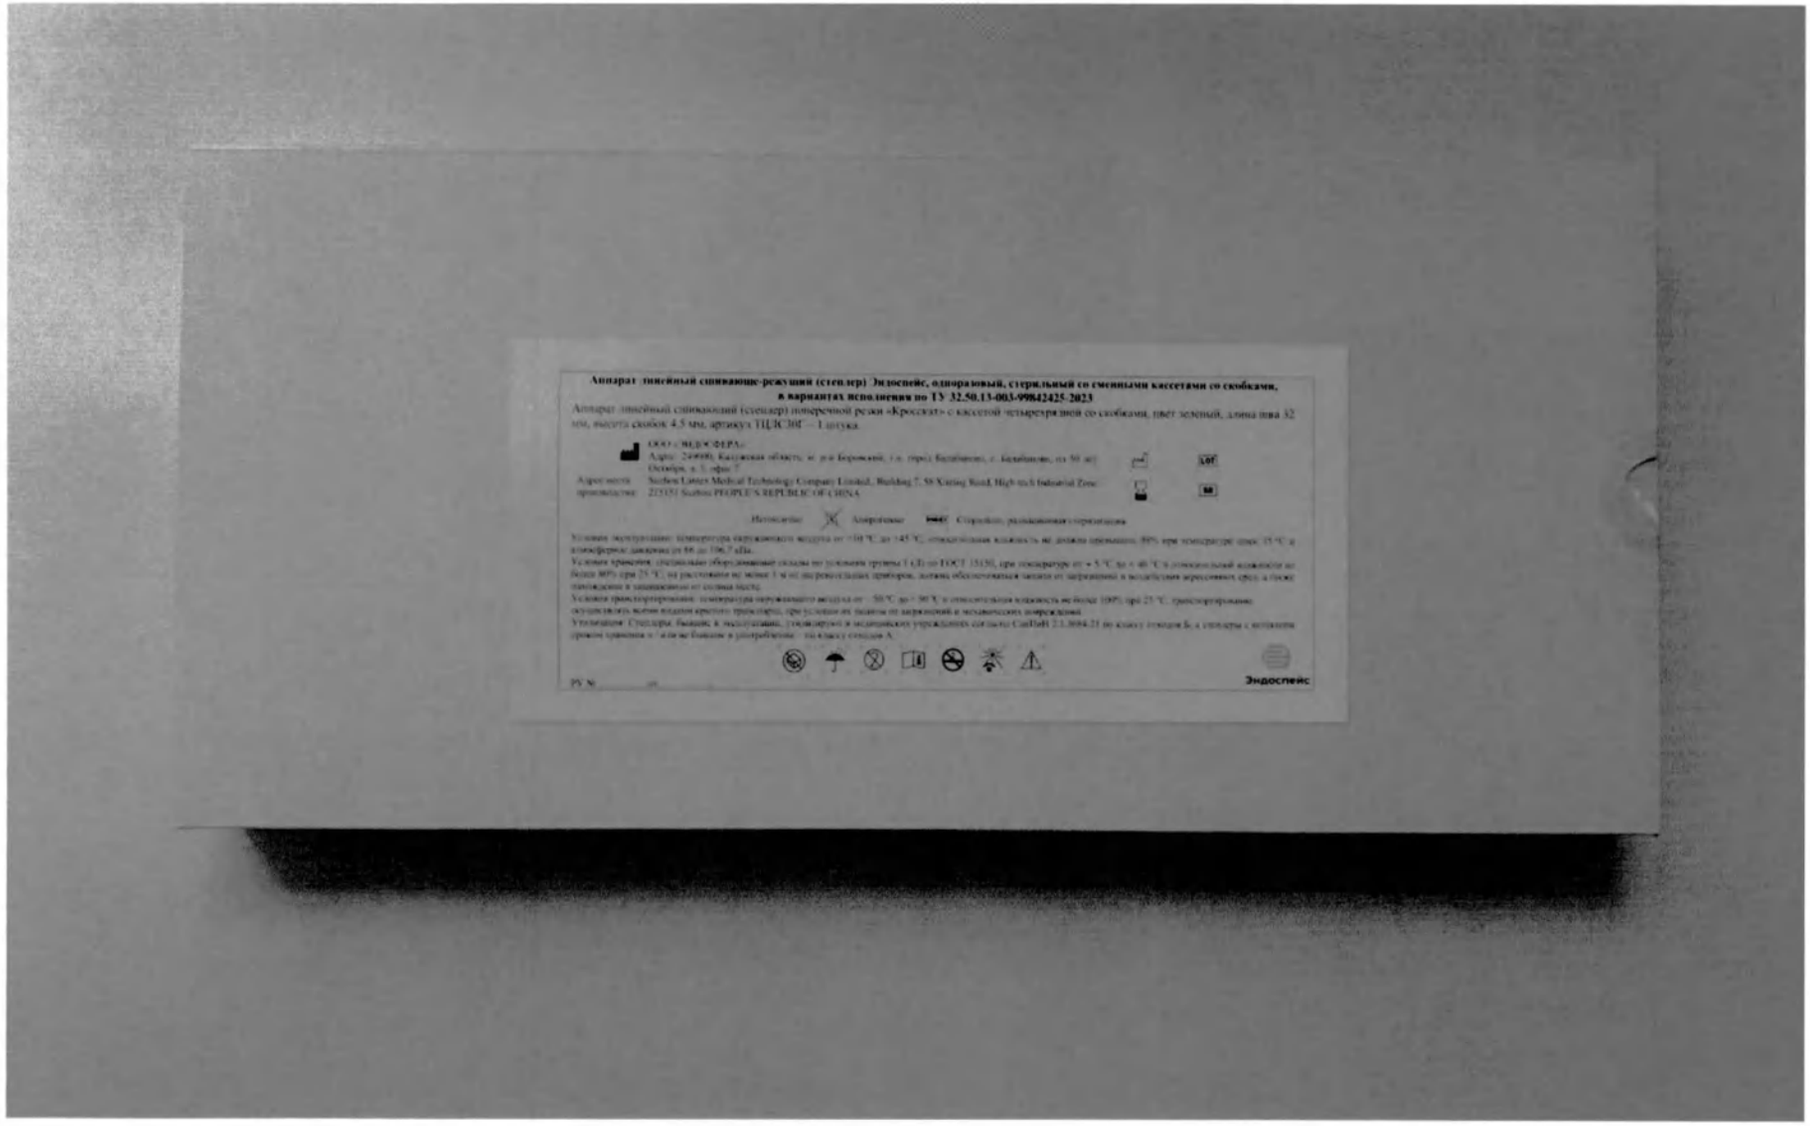

Рисунок 171 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

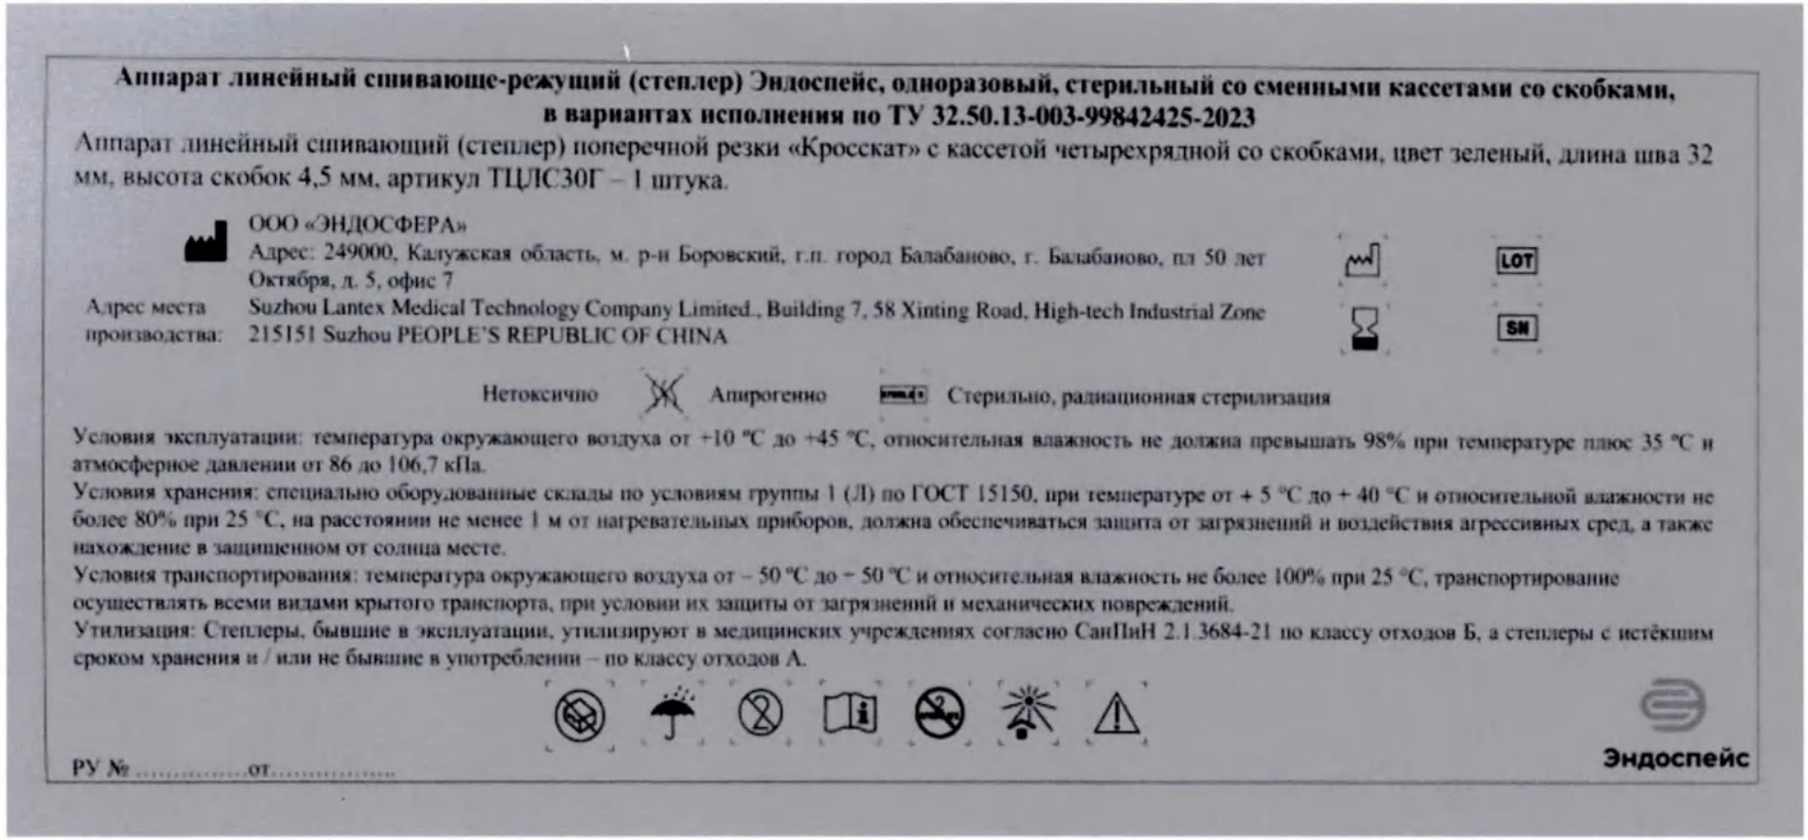

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 171А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

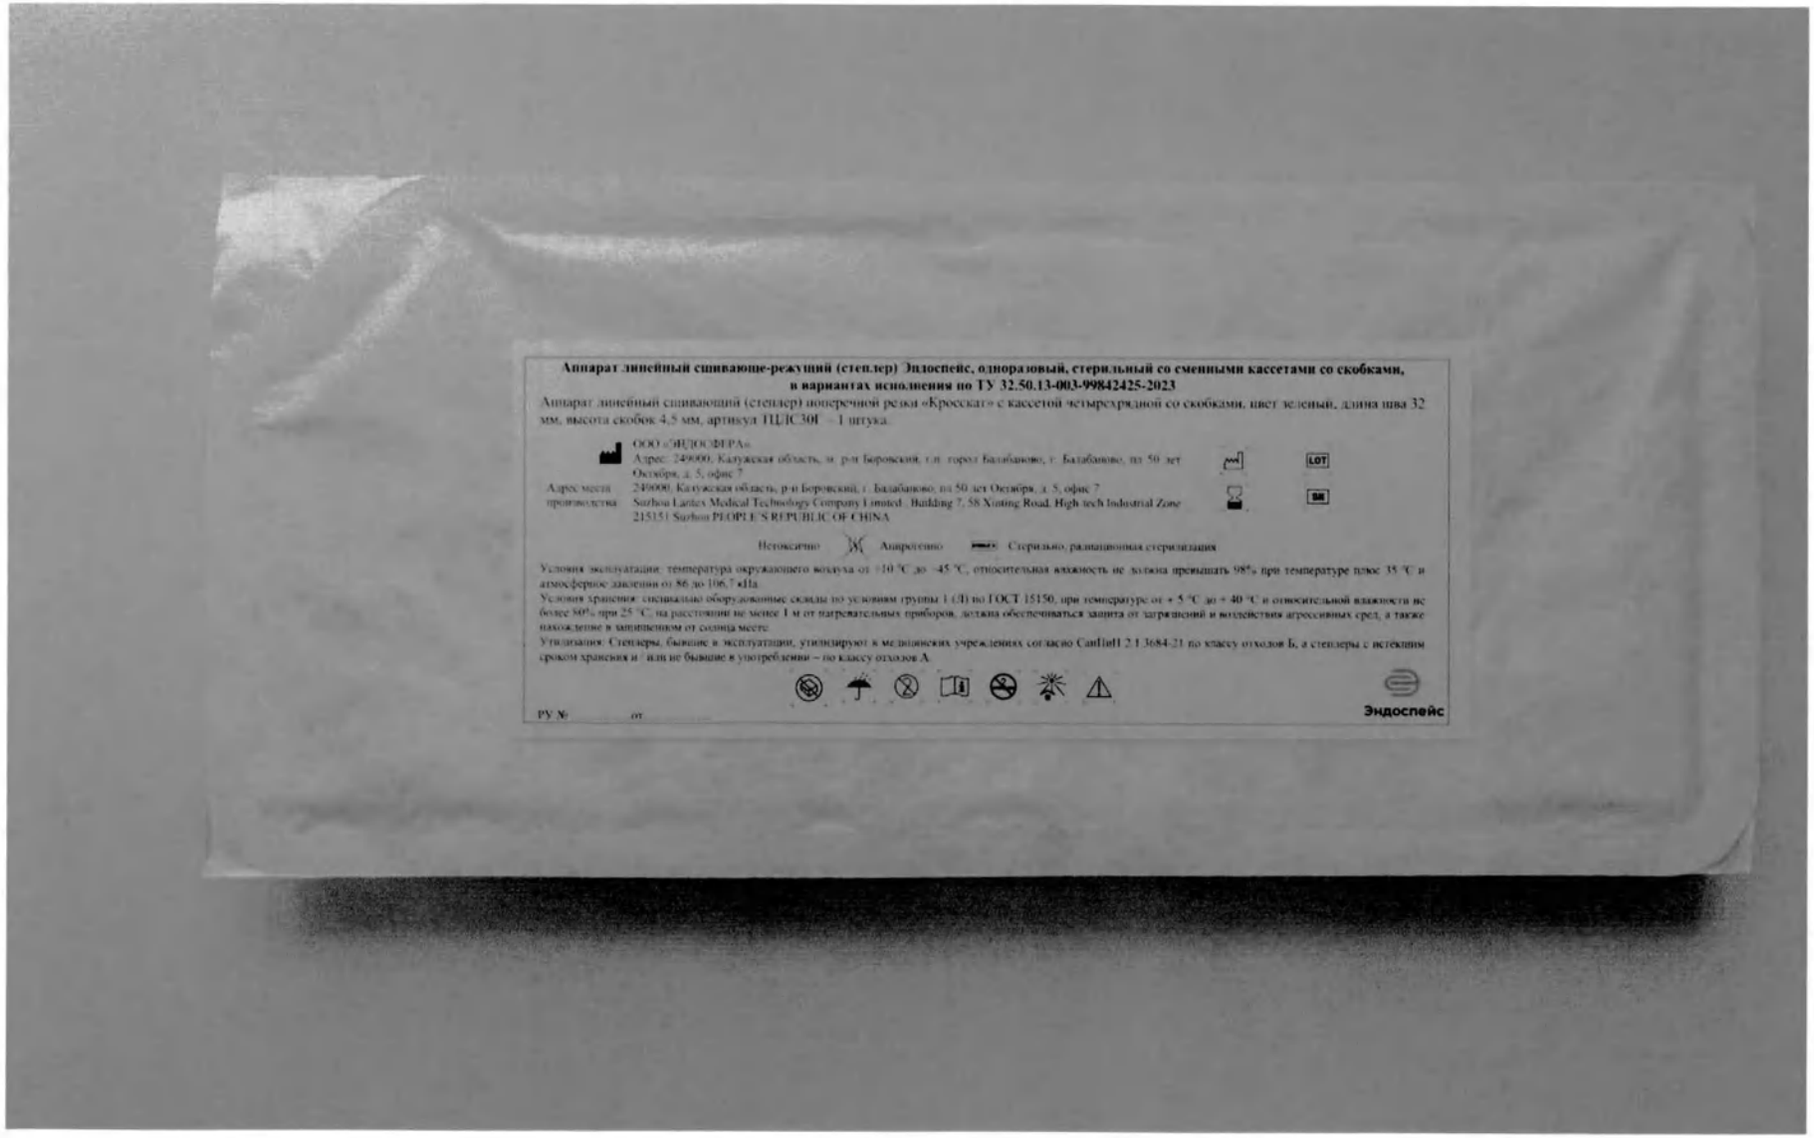

Рисунок 172 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 172А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 173 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

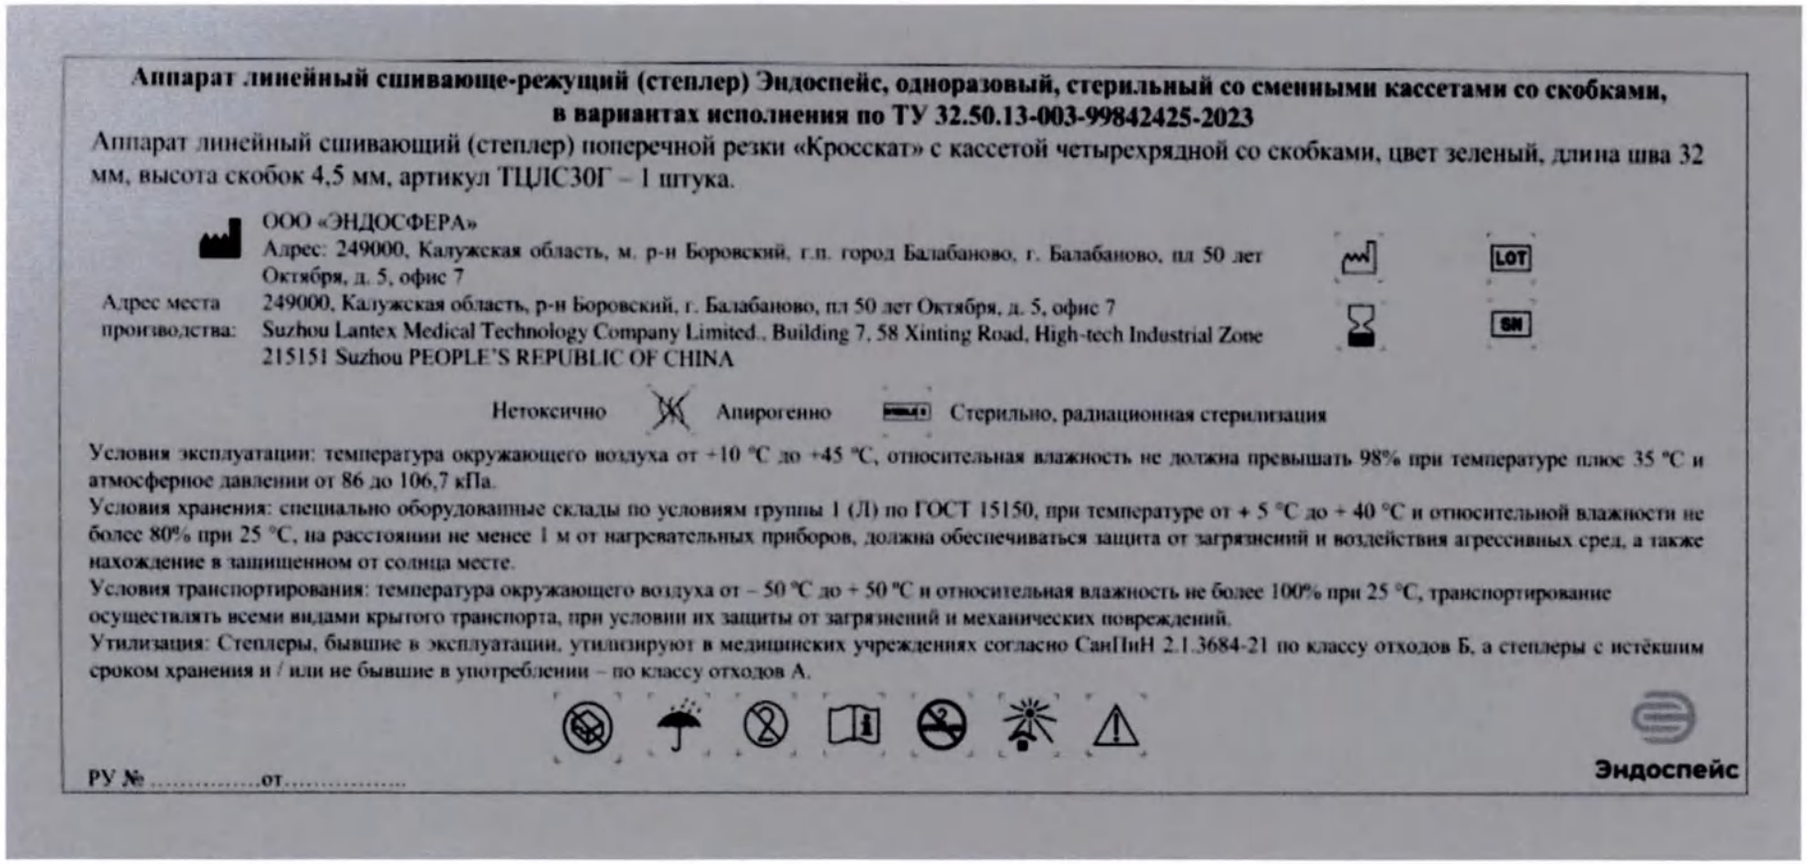

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 173А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

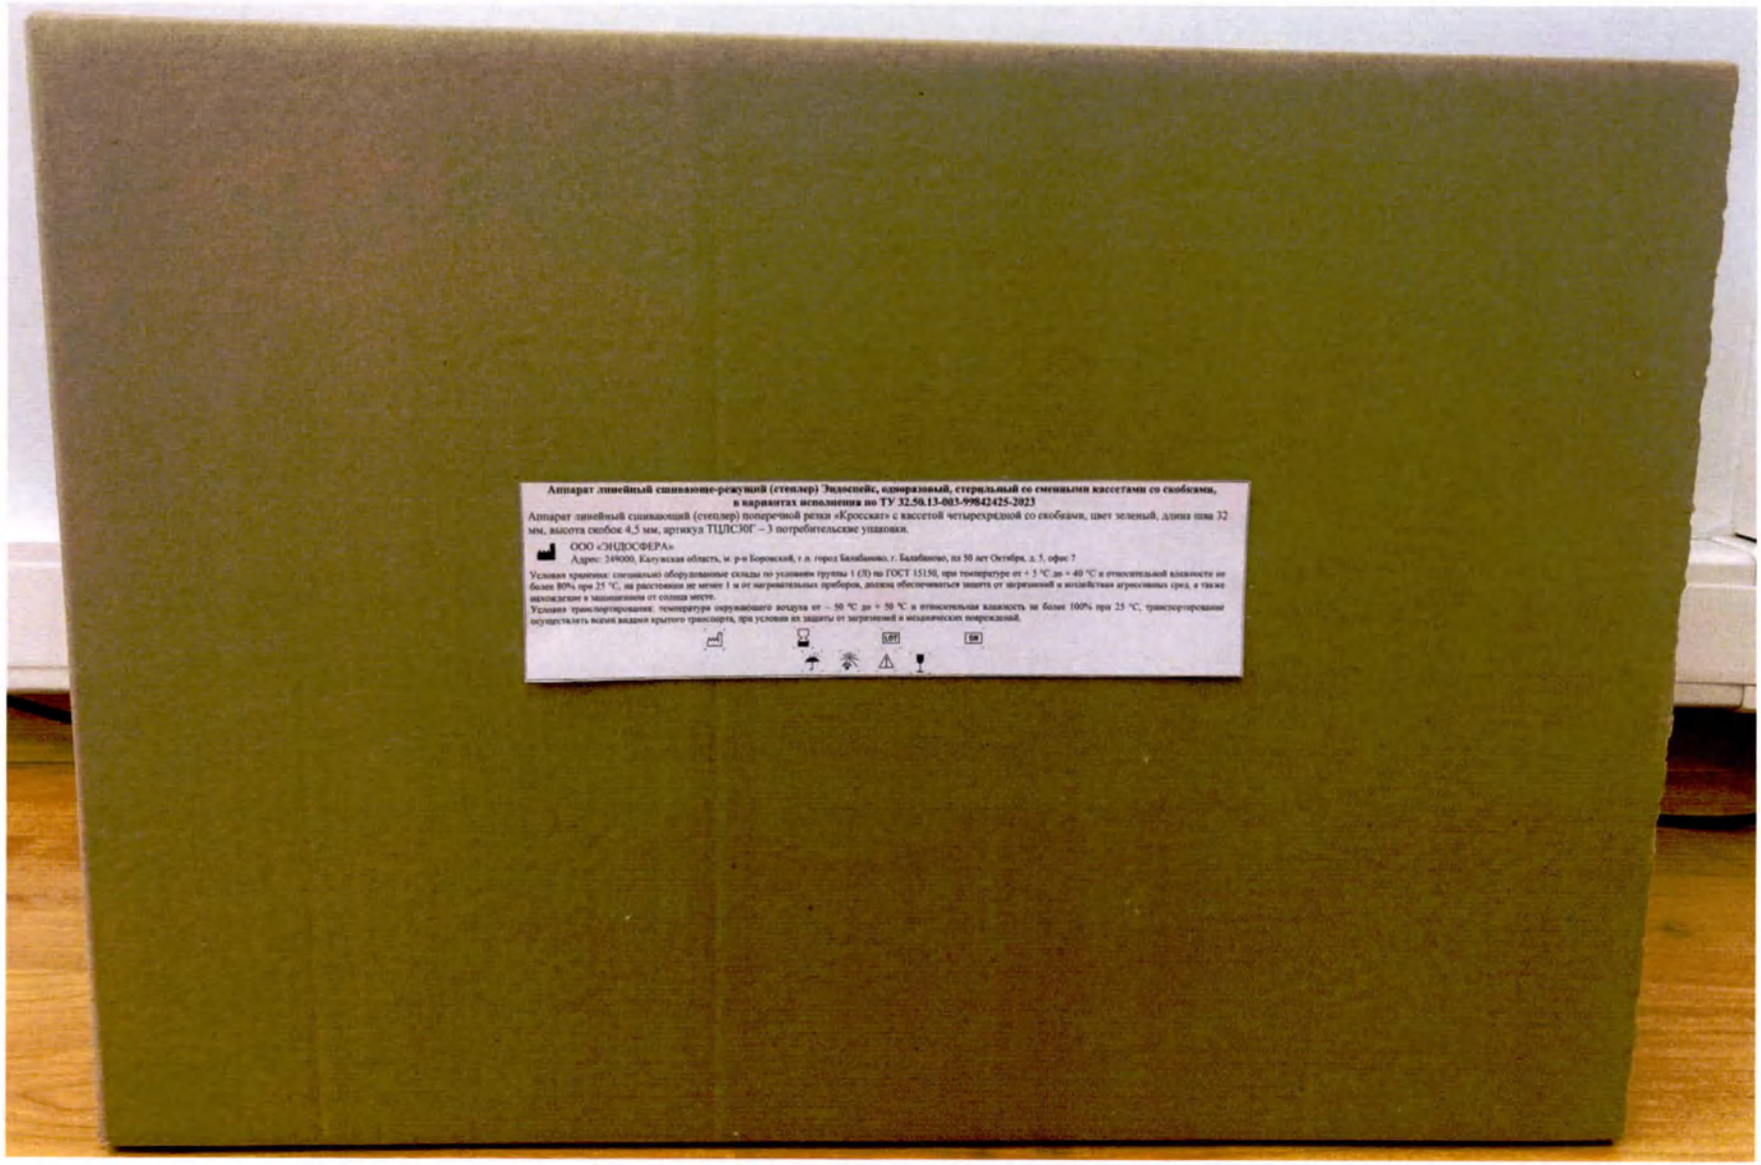

Рисунок 174 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

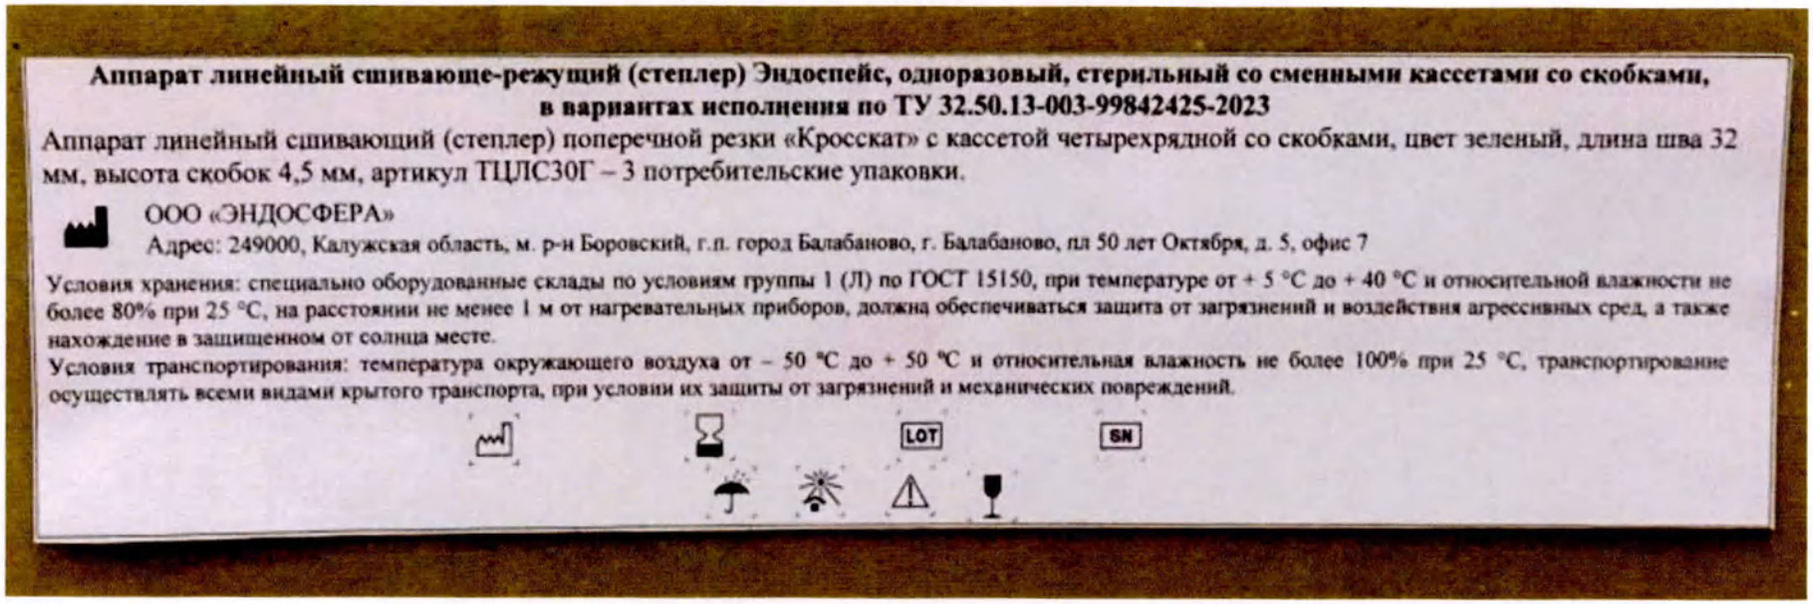

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

LOT SN

Рисунок 174А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС30Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

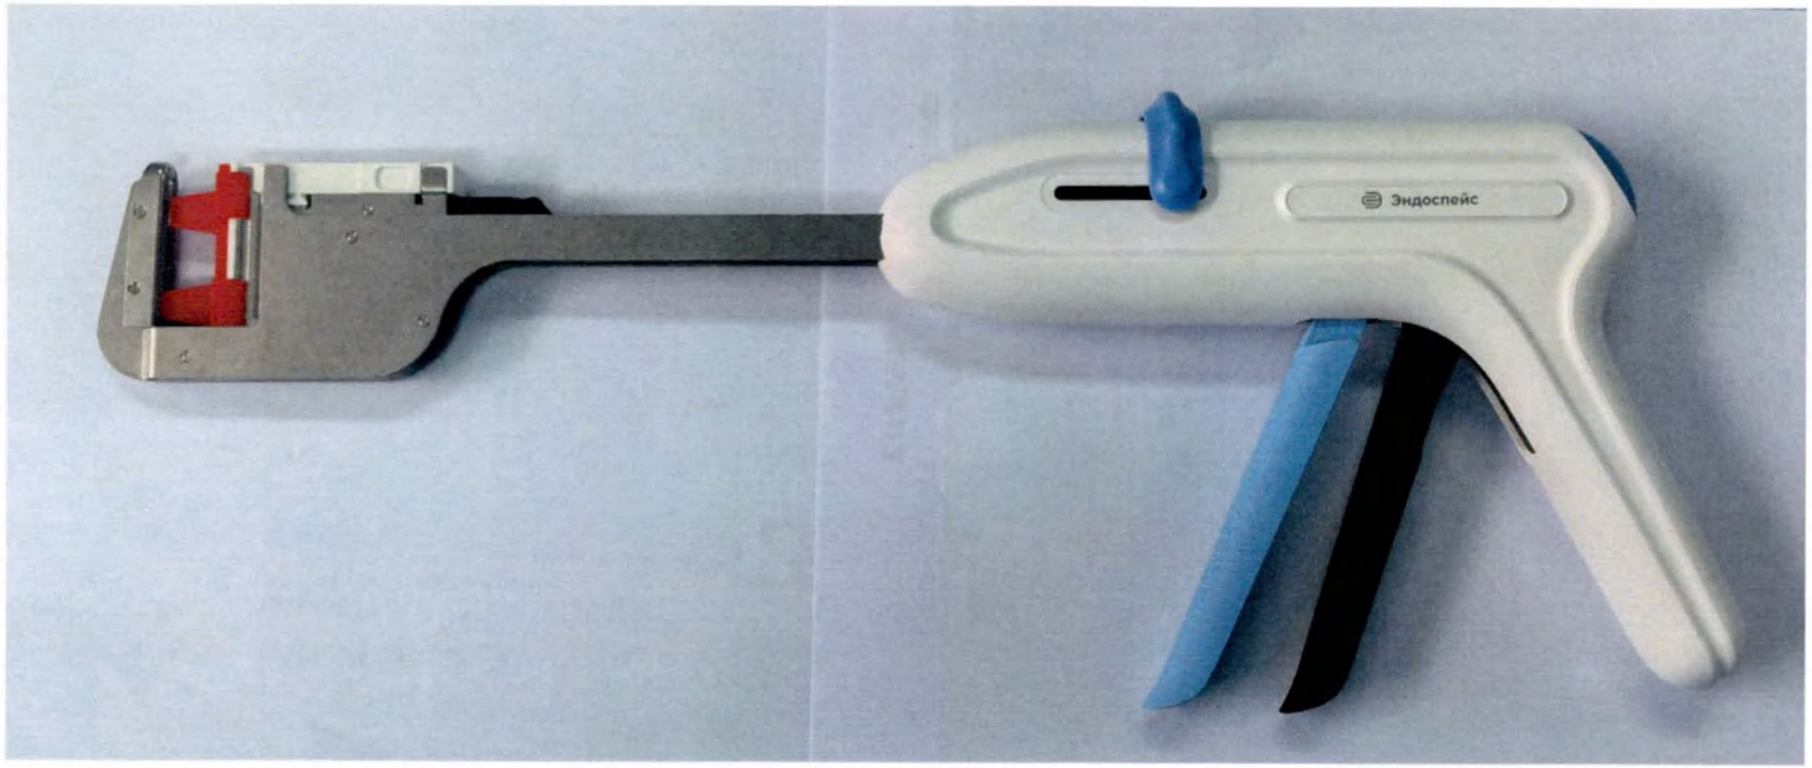

Рисунок 175 – Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 176 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

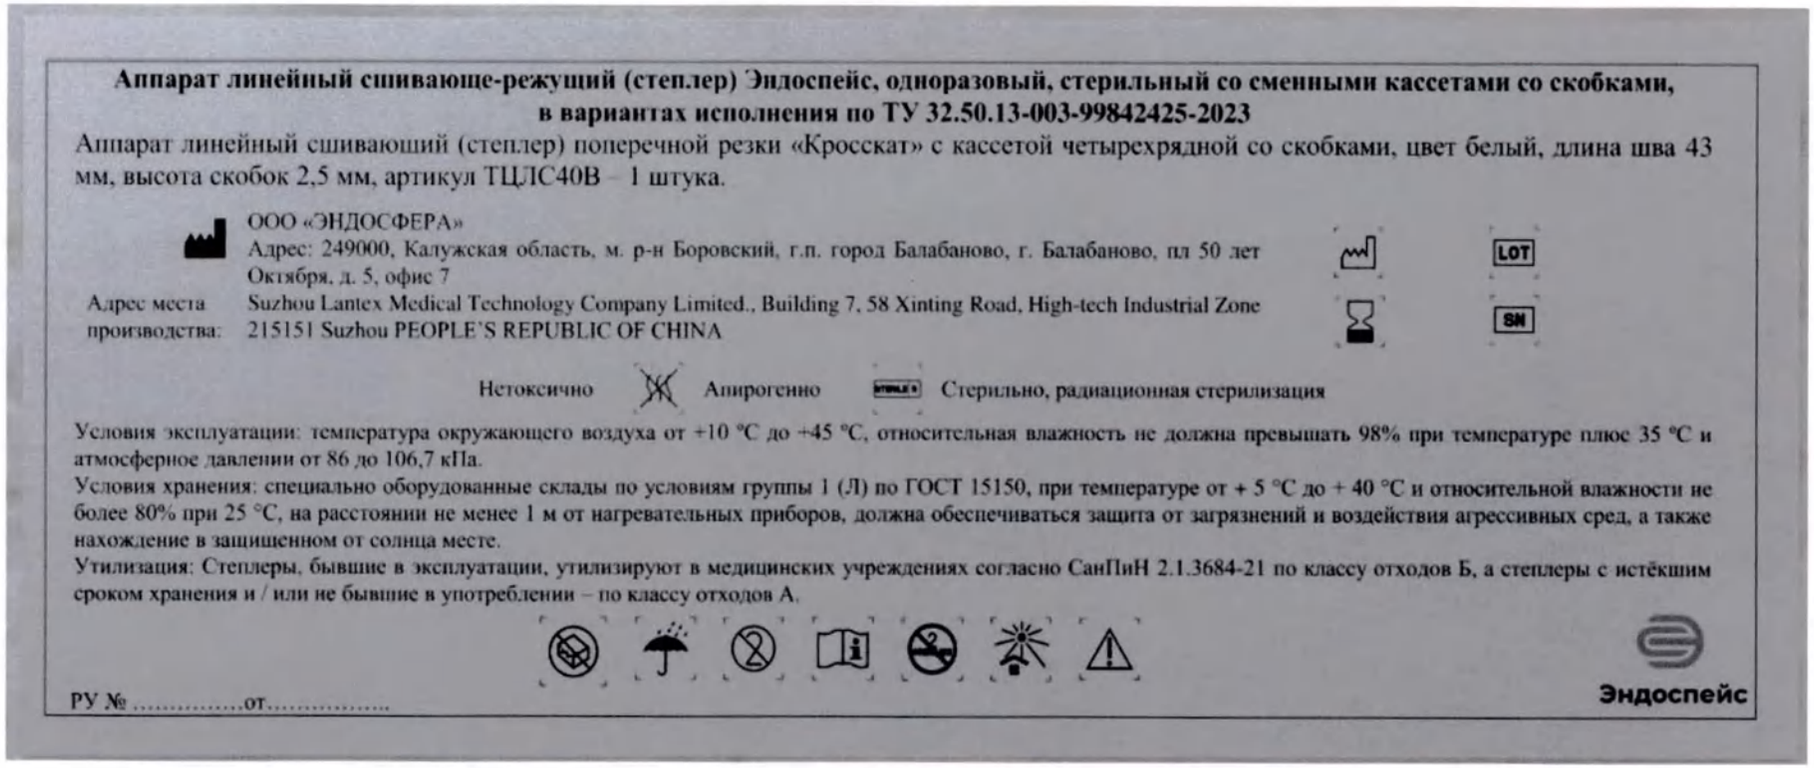

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 176А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

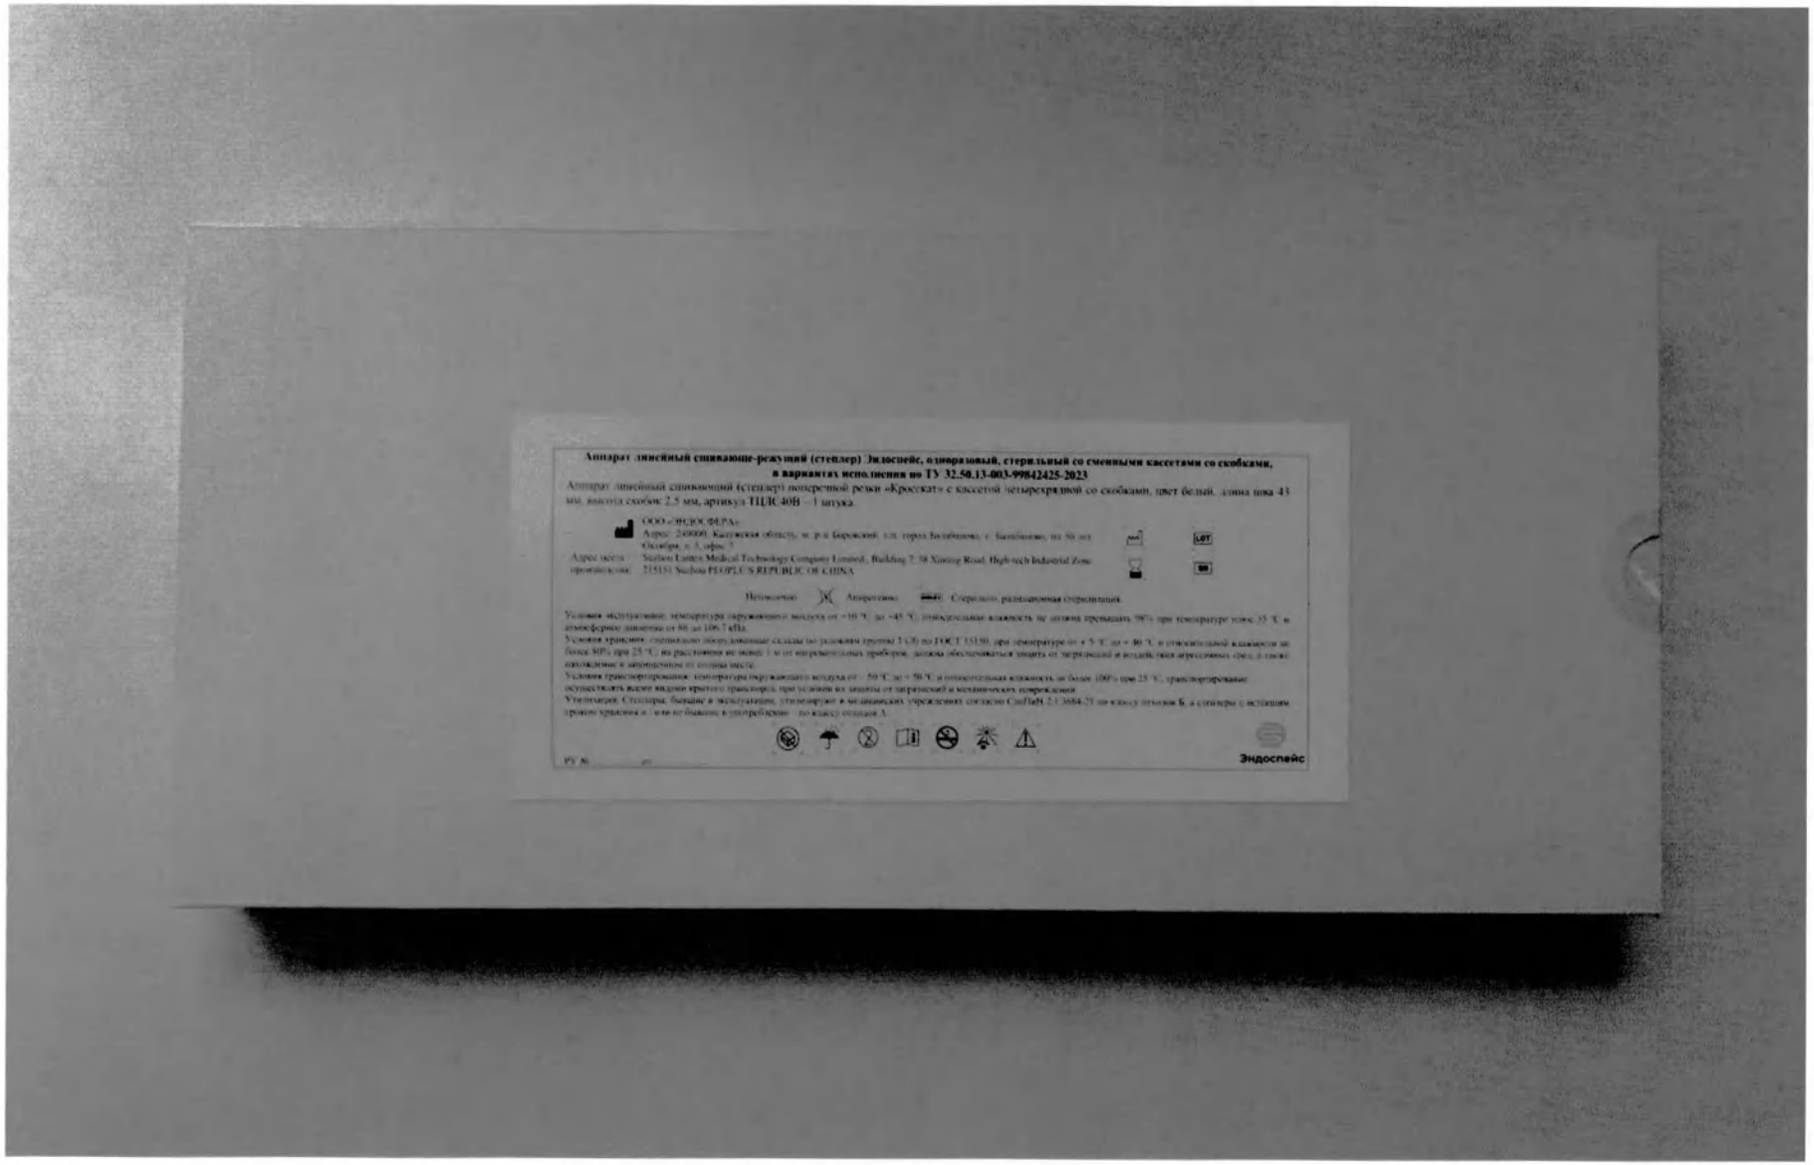

Рисунок 177 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

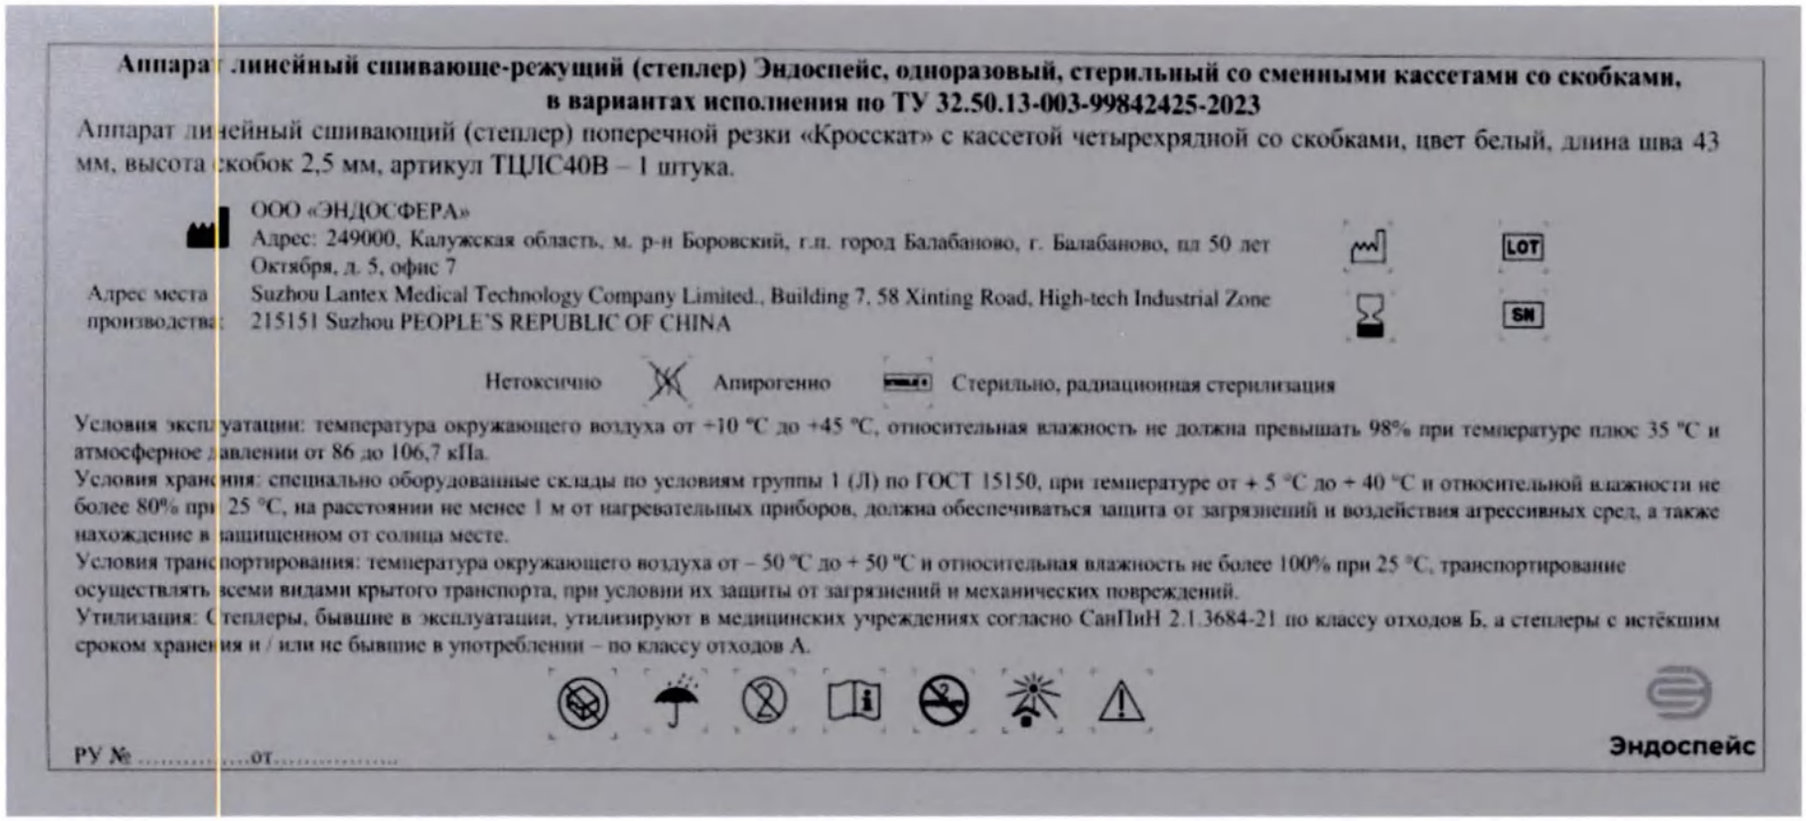

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № ……от……..

Эндоспейс

Рисунок 177А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

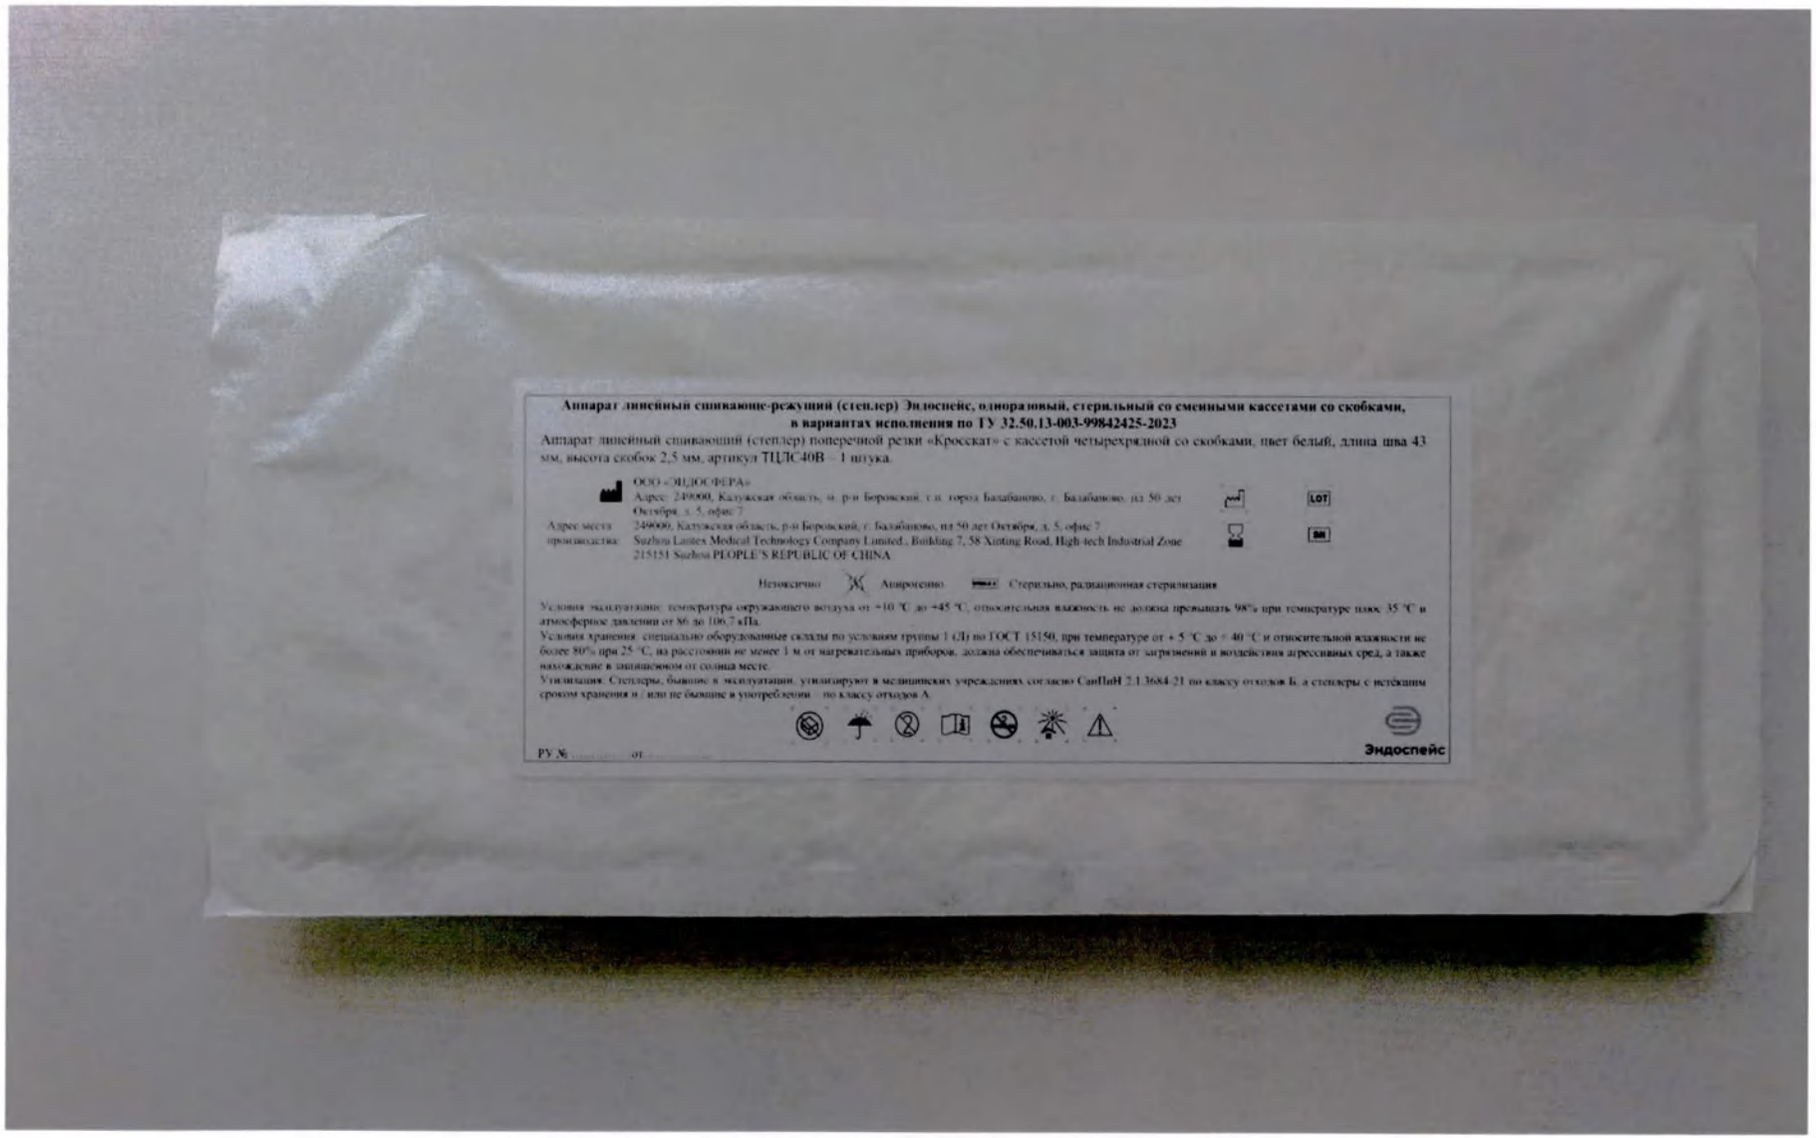

Рисунок 178 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

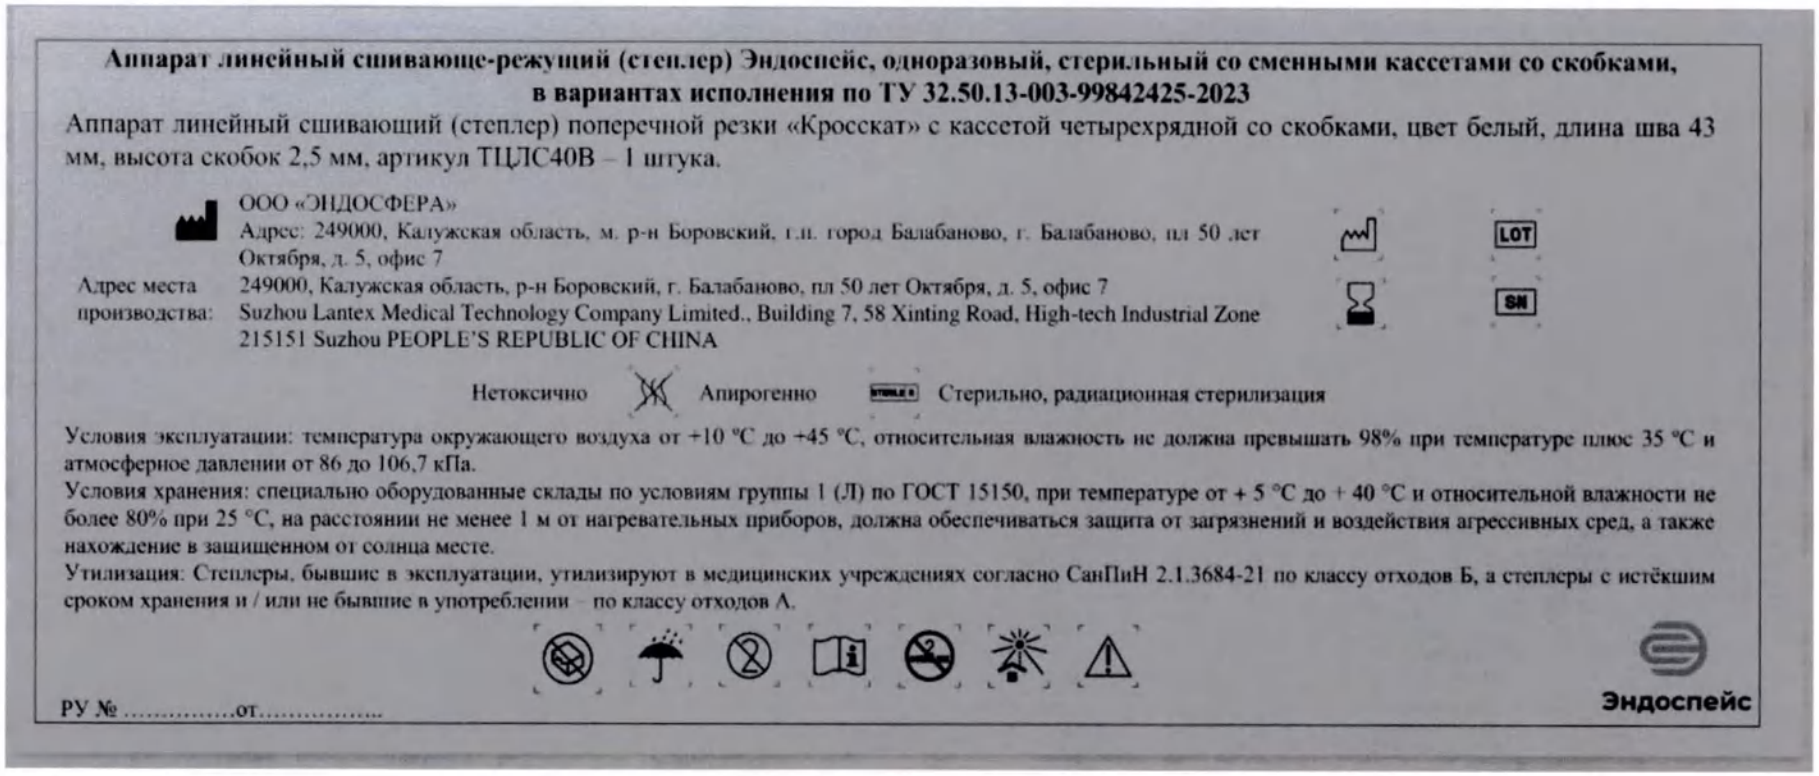

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 178А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

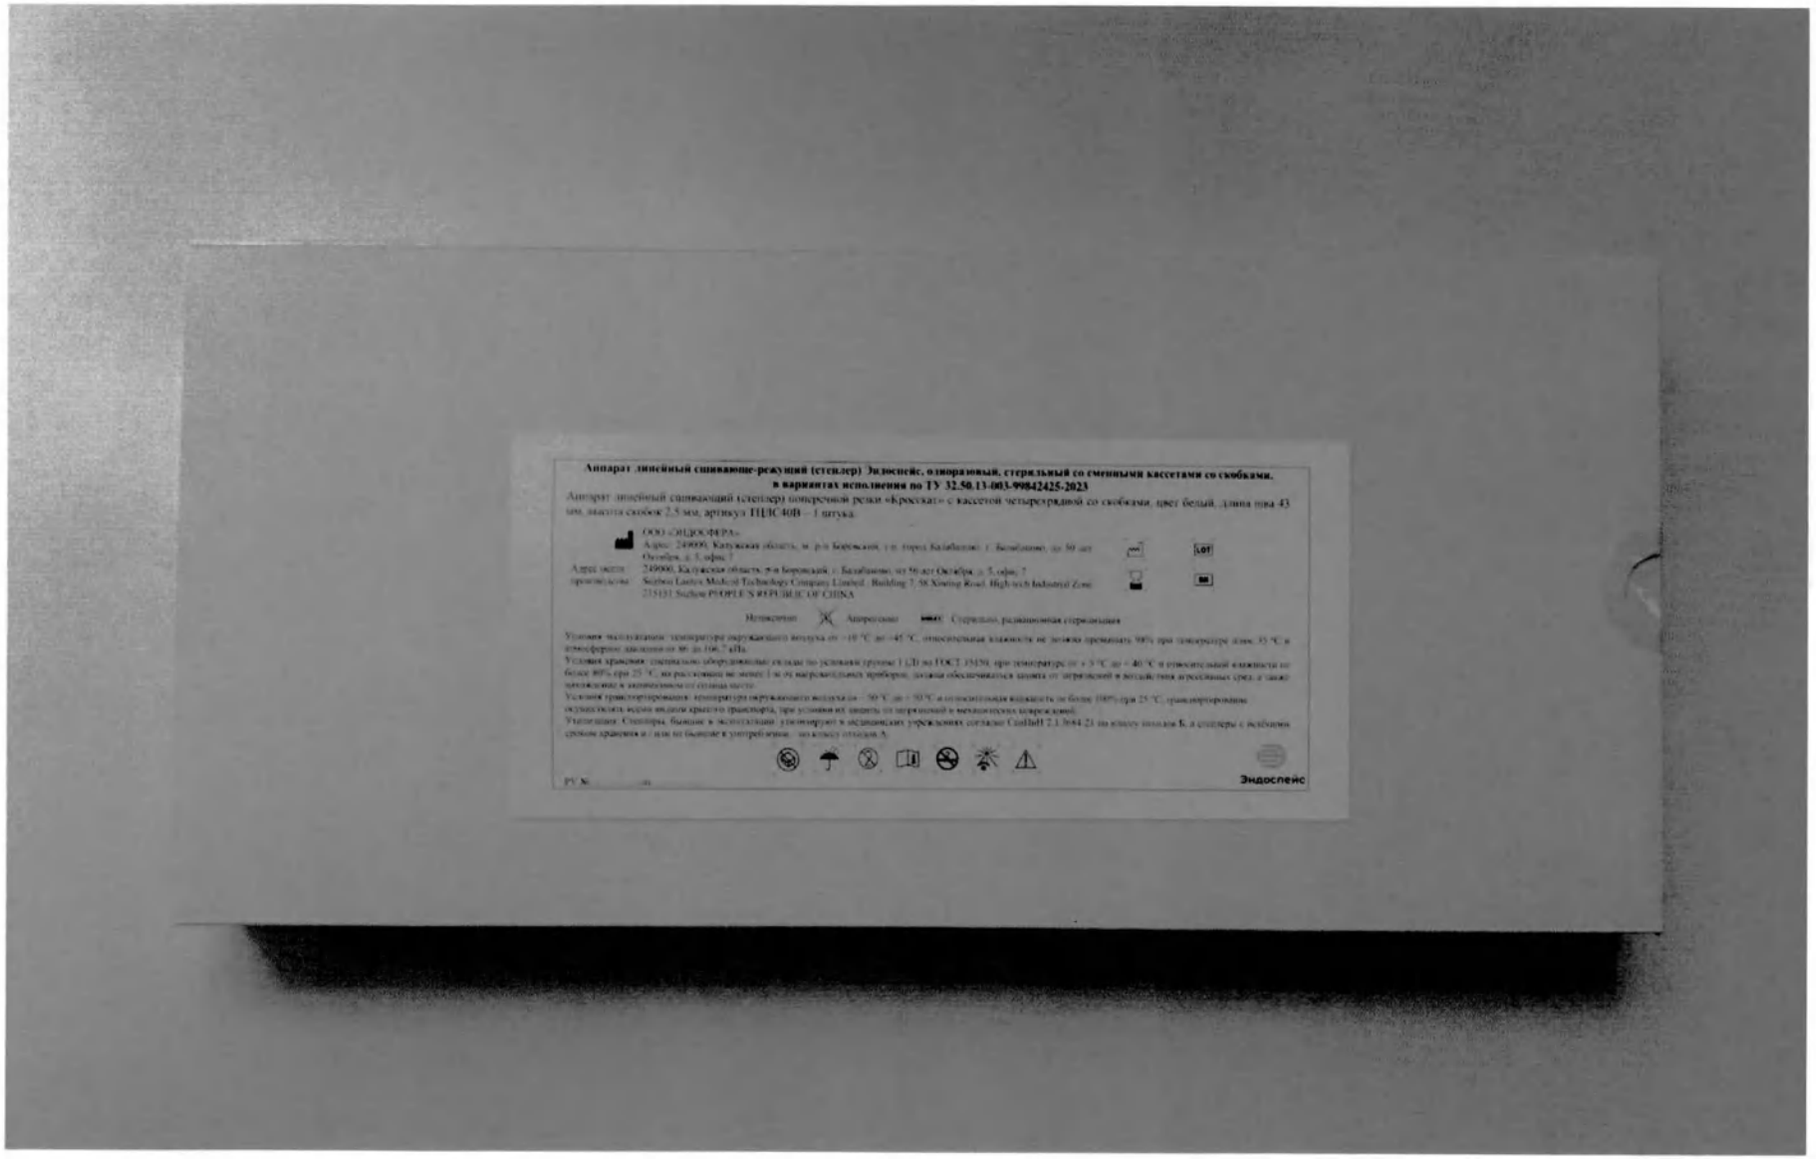

Рисунок 179 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

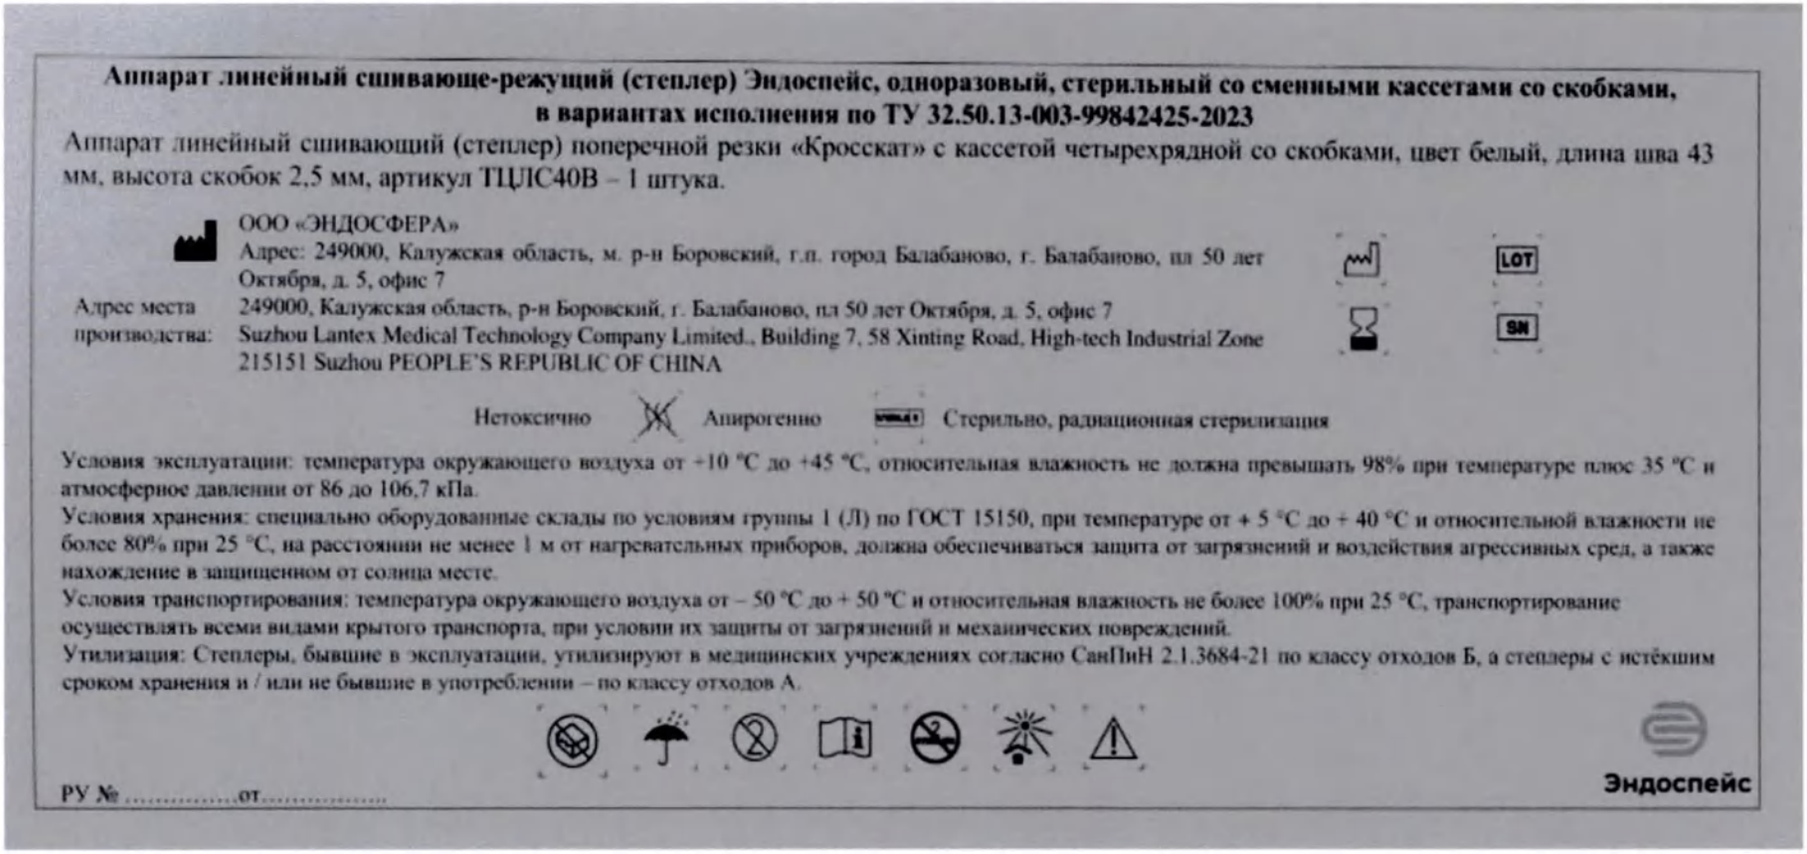

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 179А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 180 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

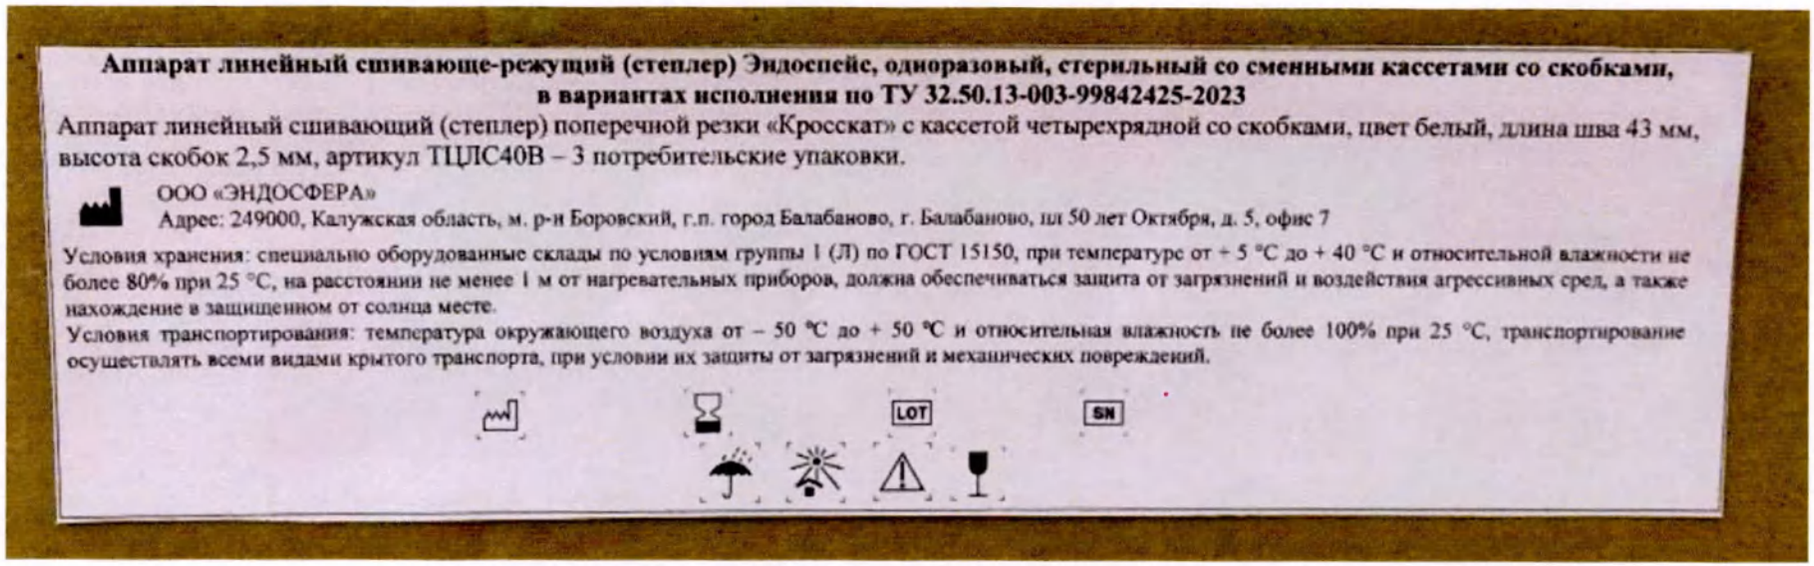

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 180А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет белый, длина шва 43 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул ТЦЛС40В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

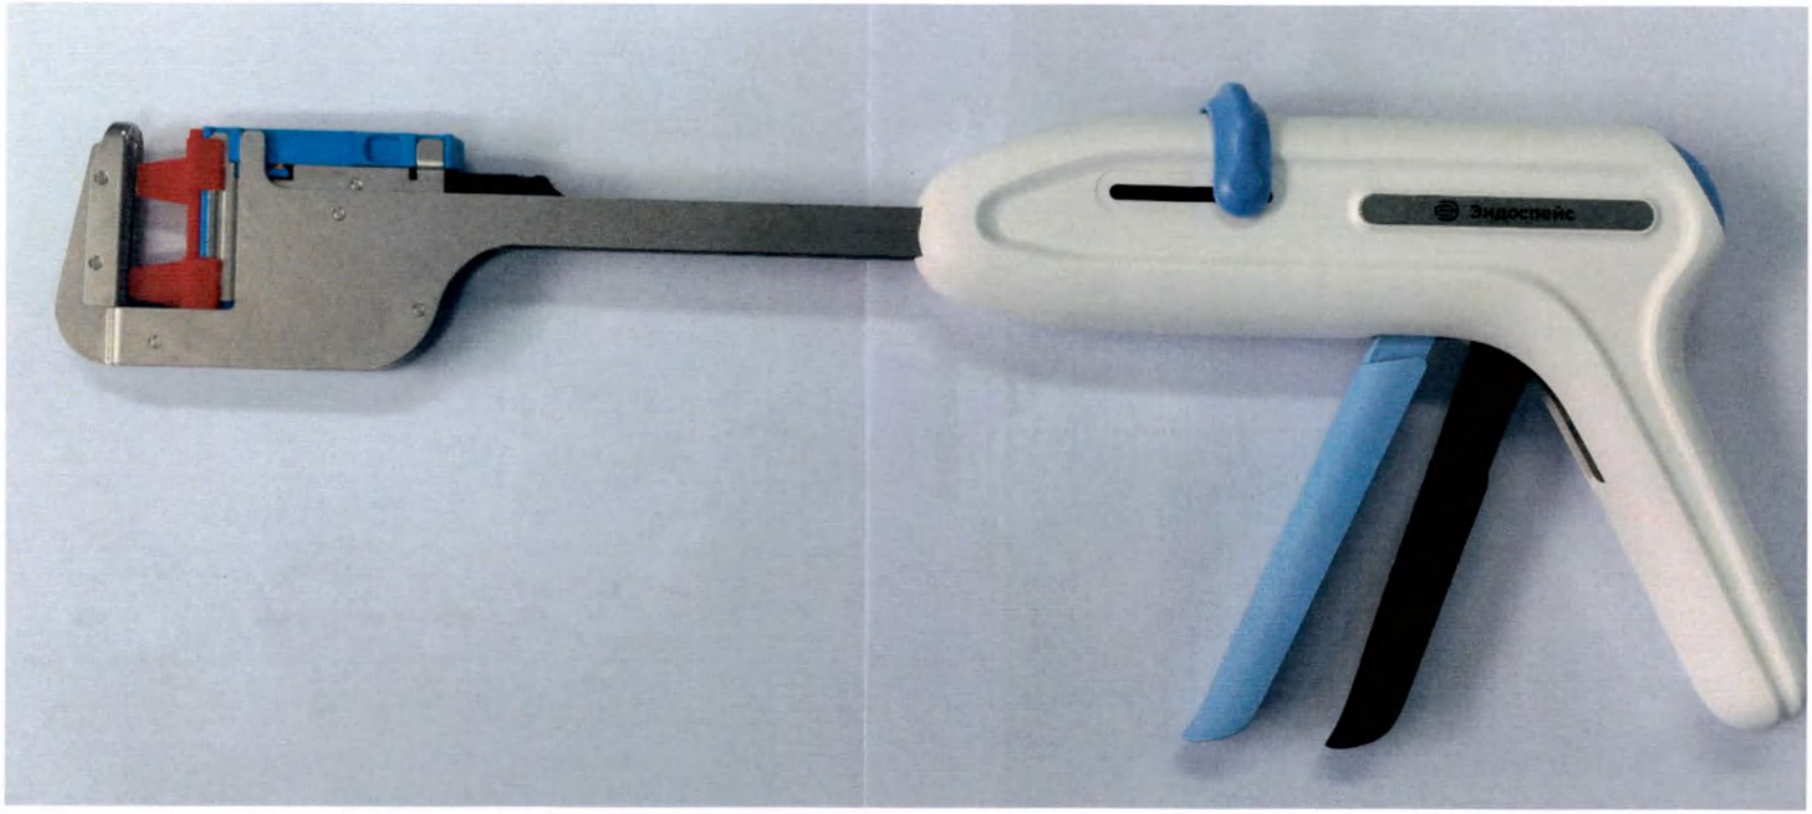

Рисунок 181 – Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

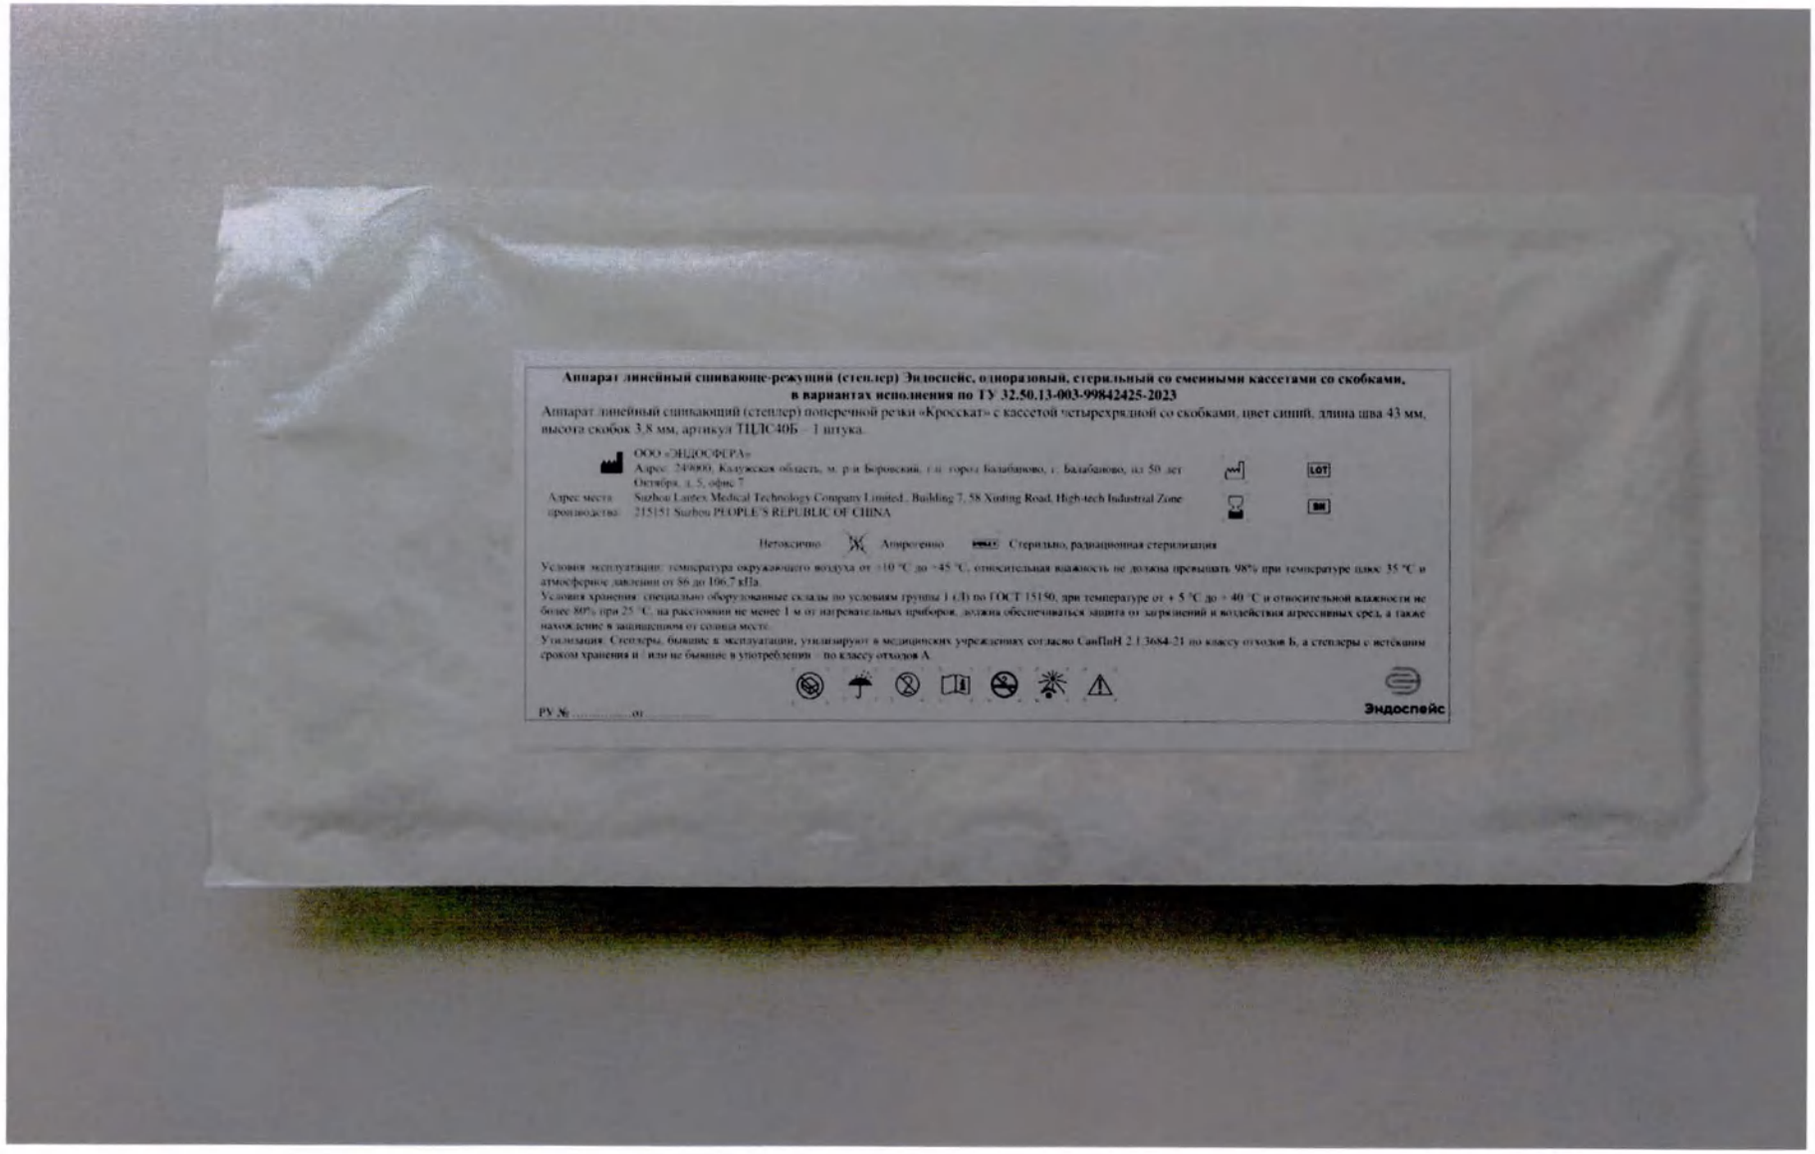

Рисунок 182 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 182А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

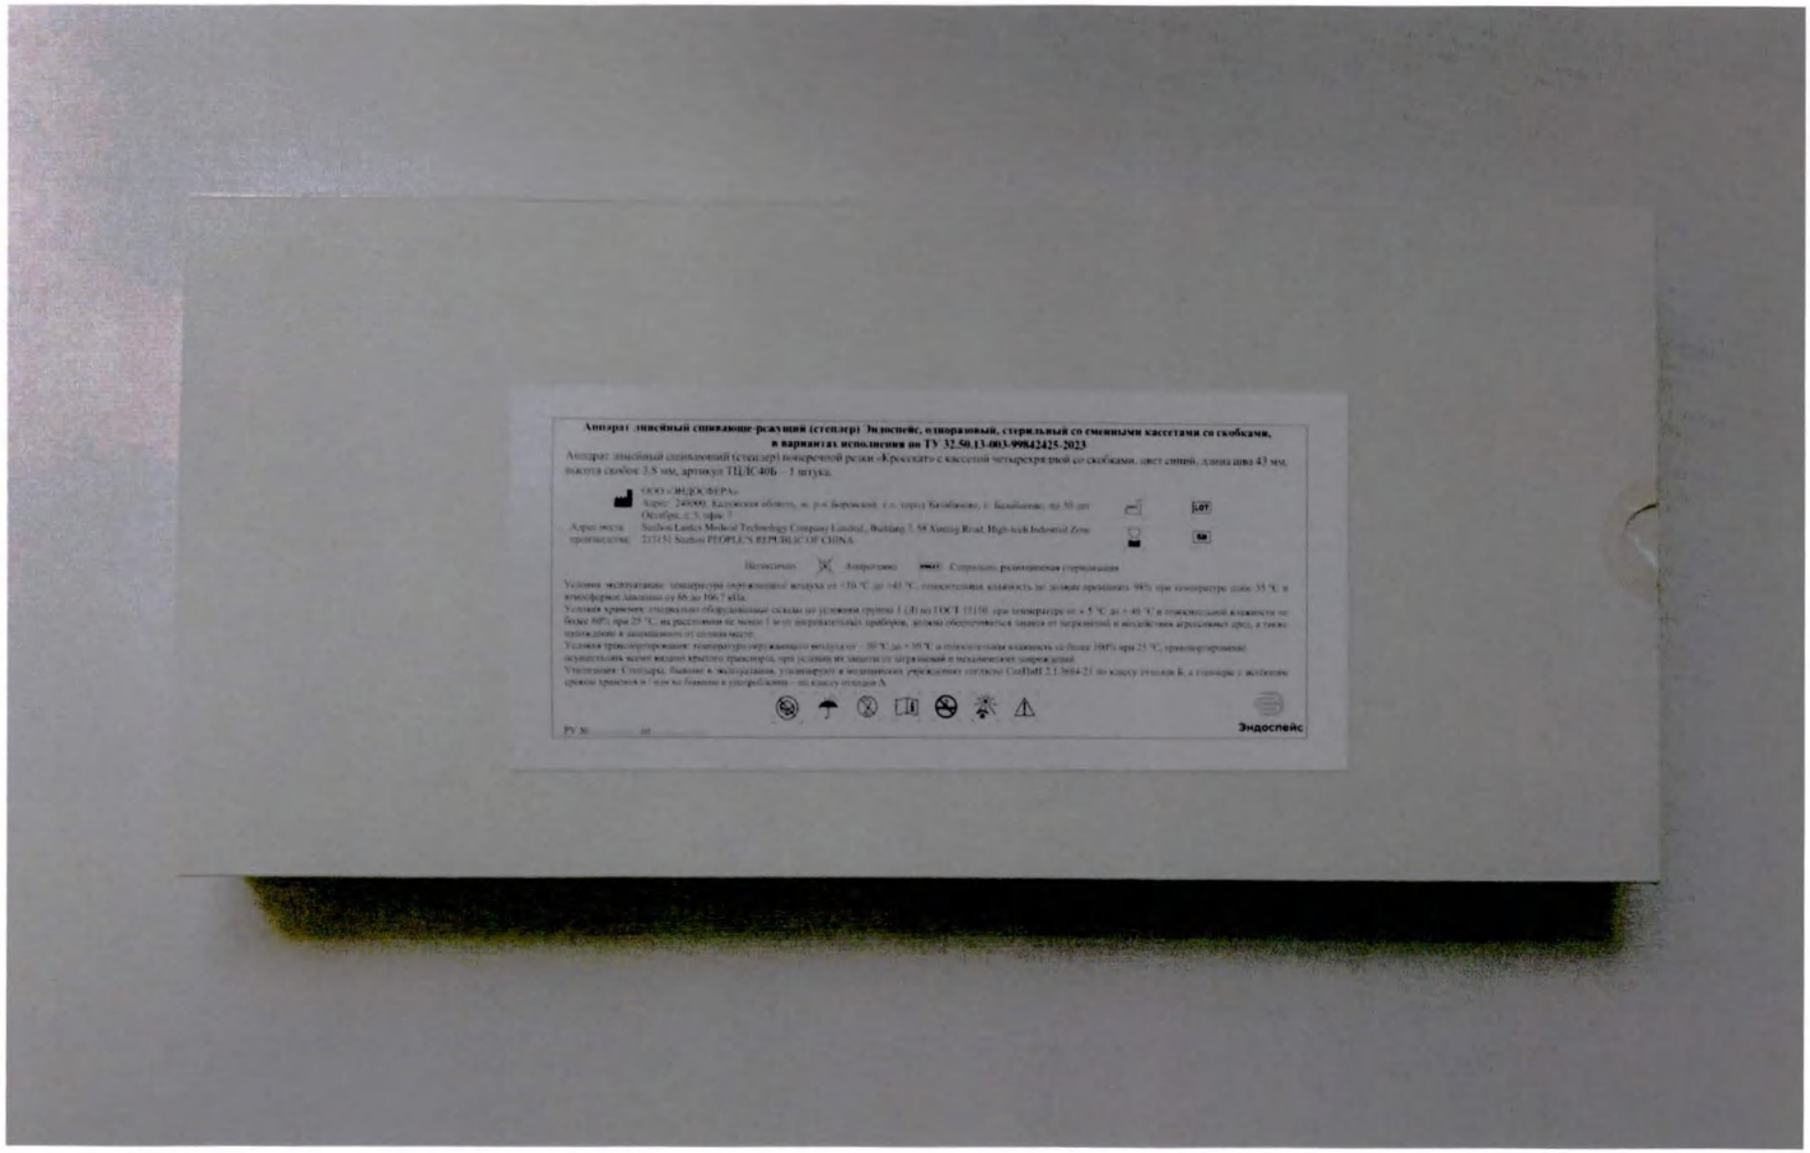

Рисунок 183 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

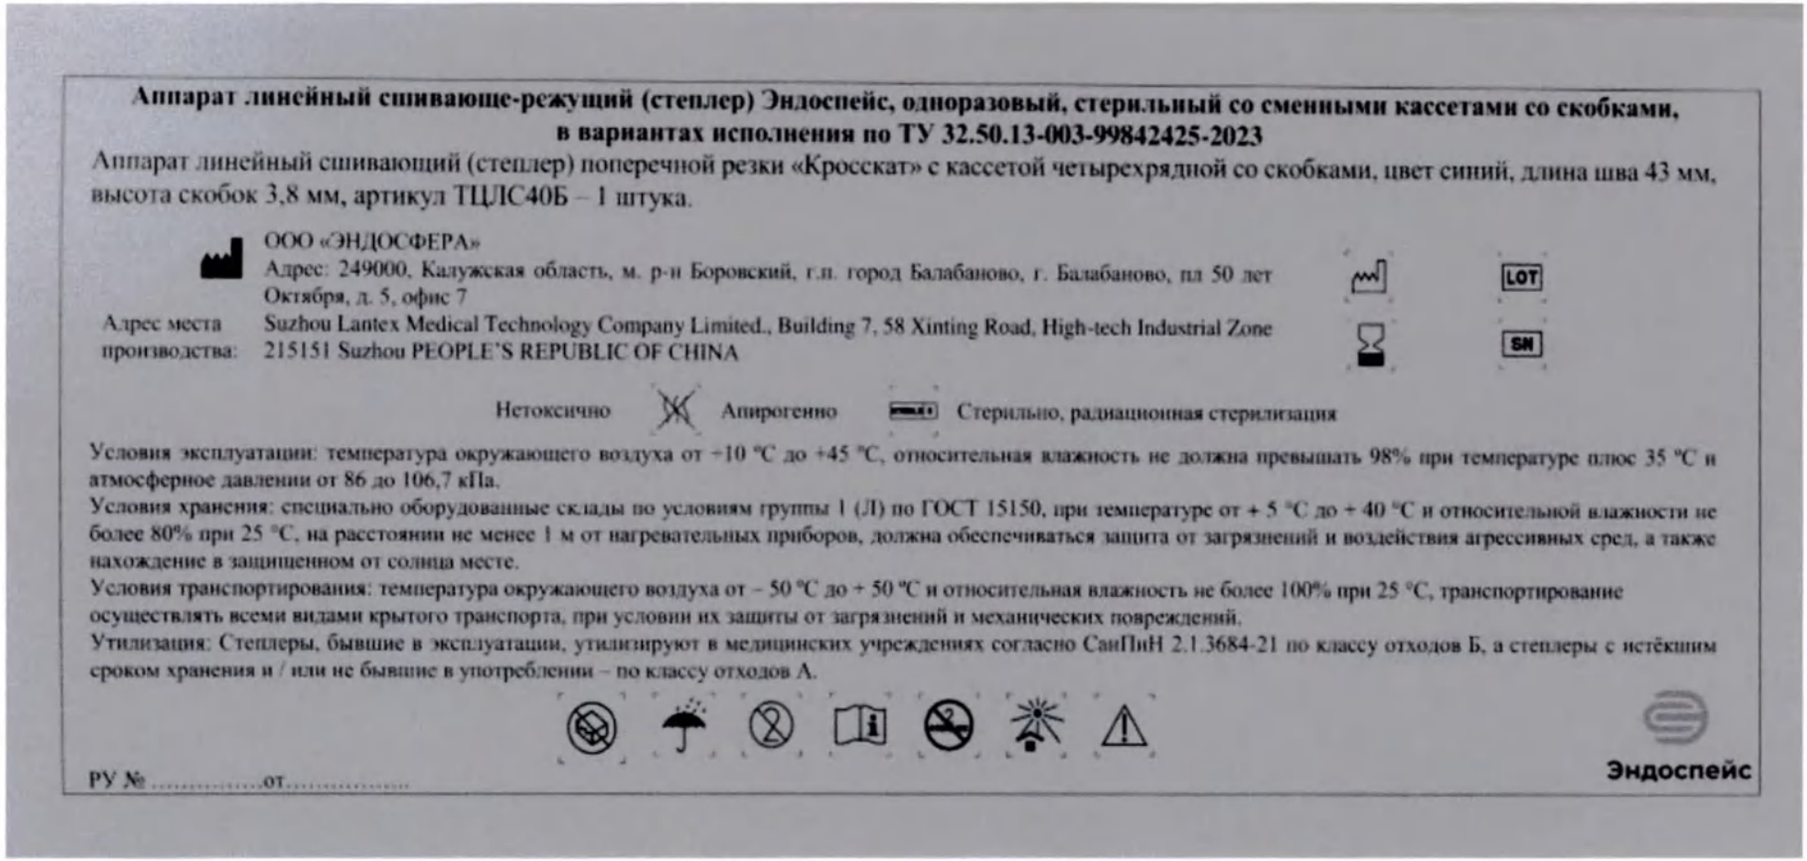

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 183А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

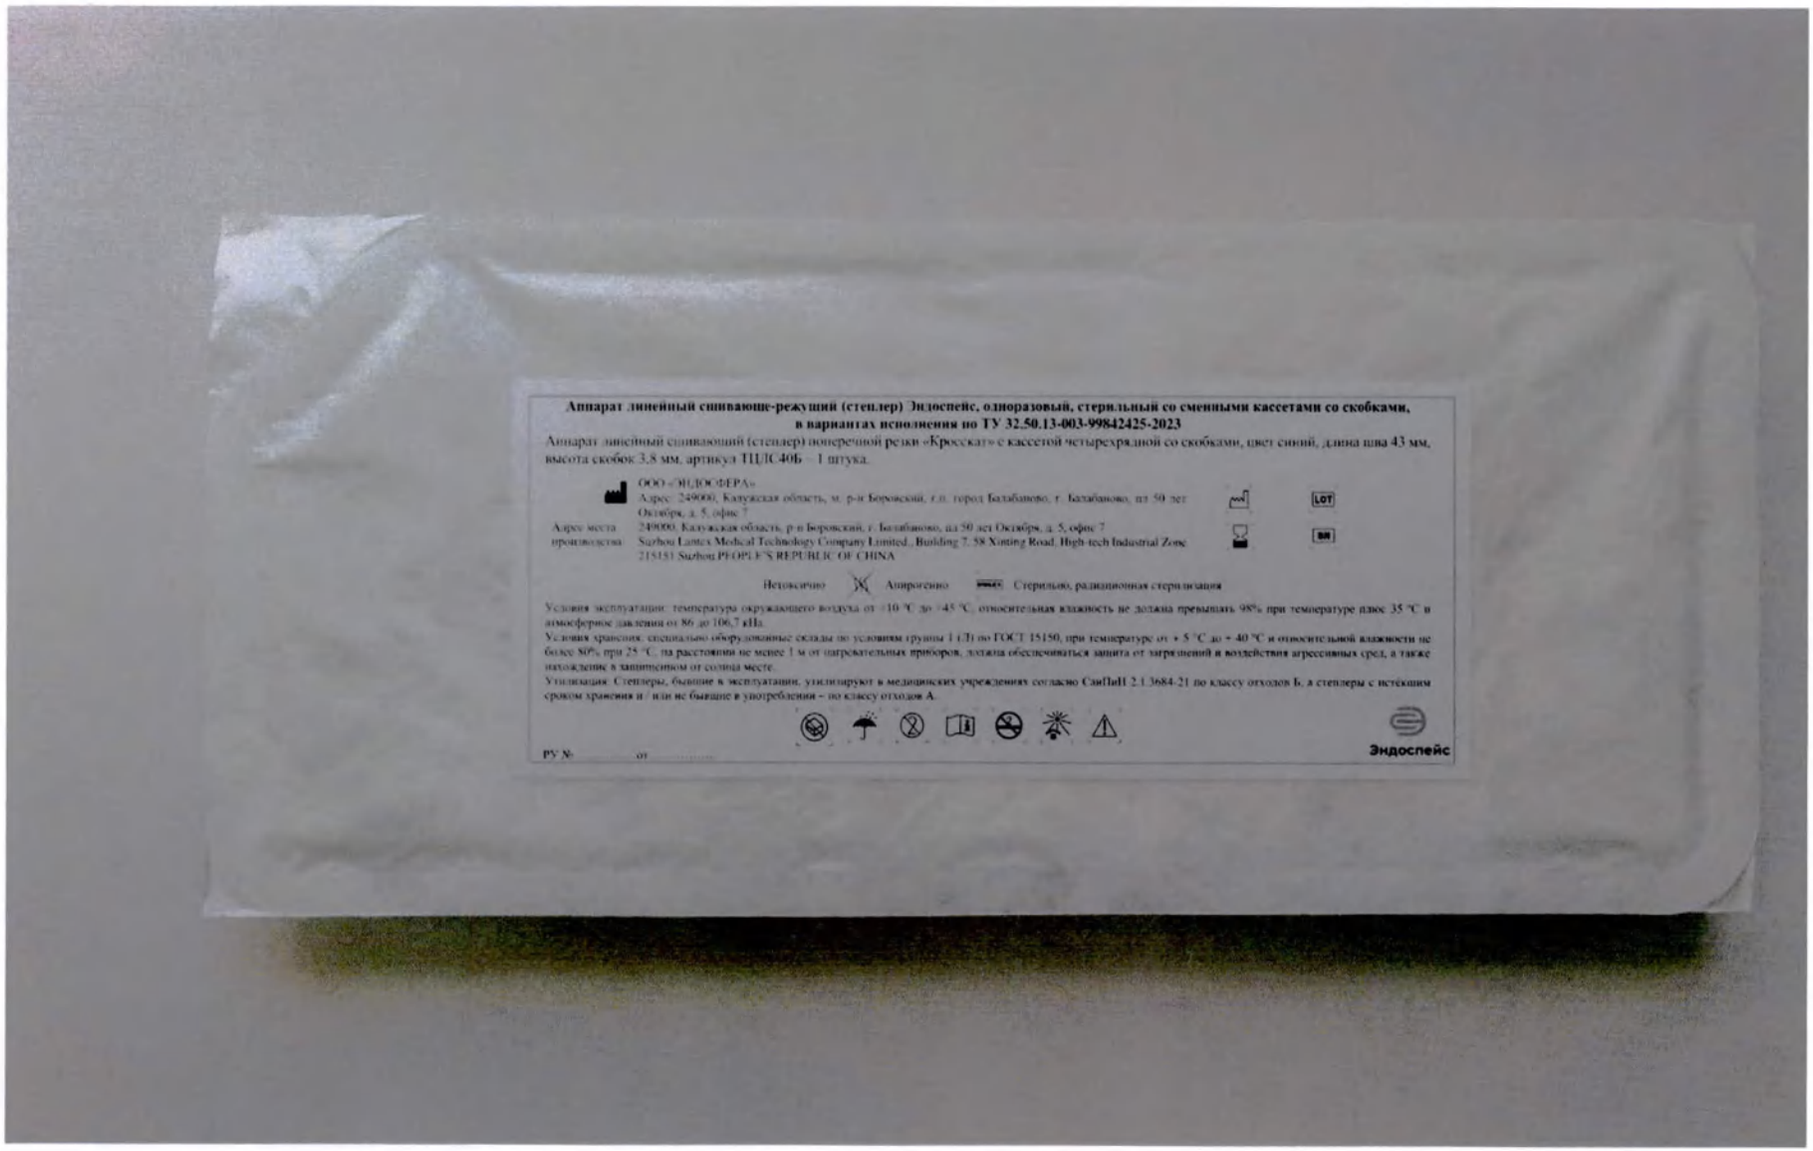

Рисунок 184 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

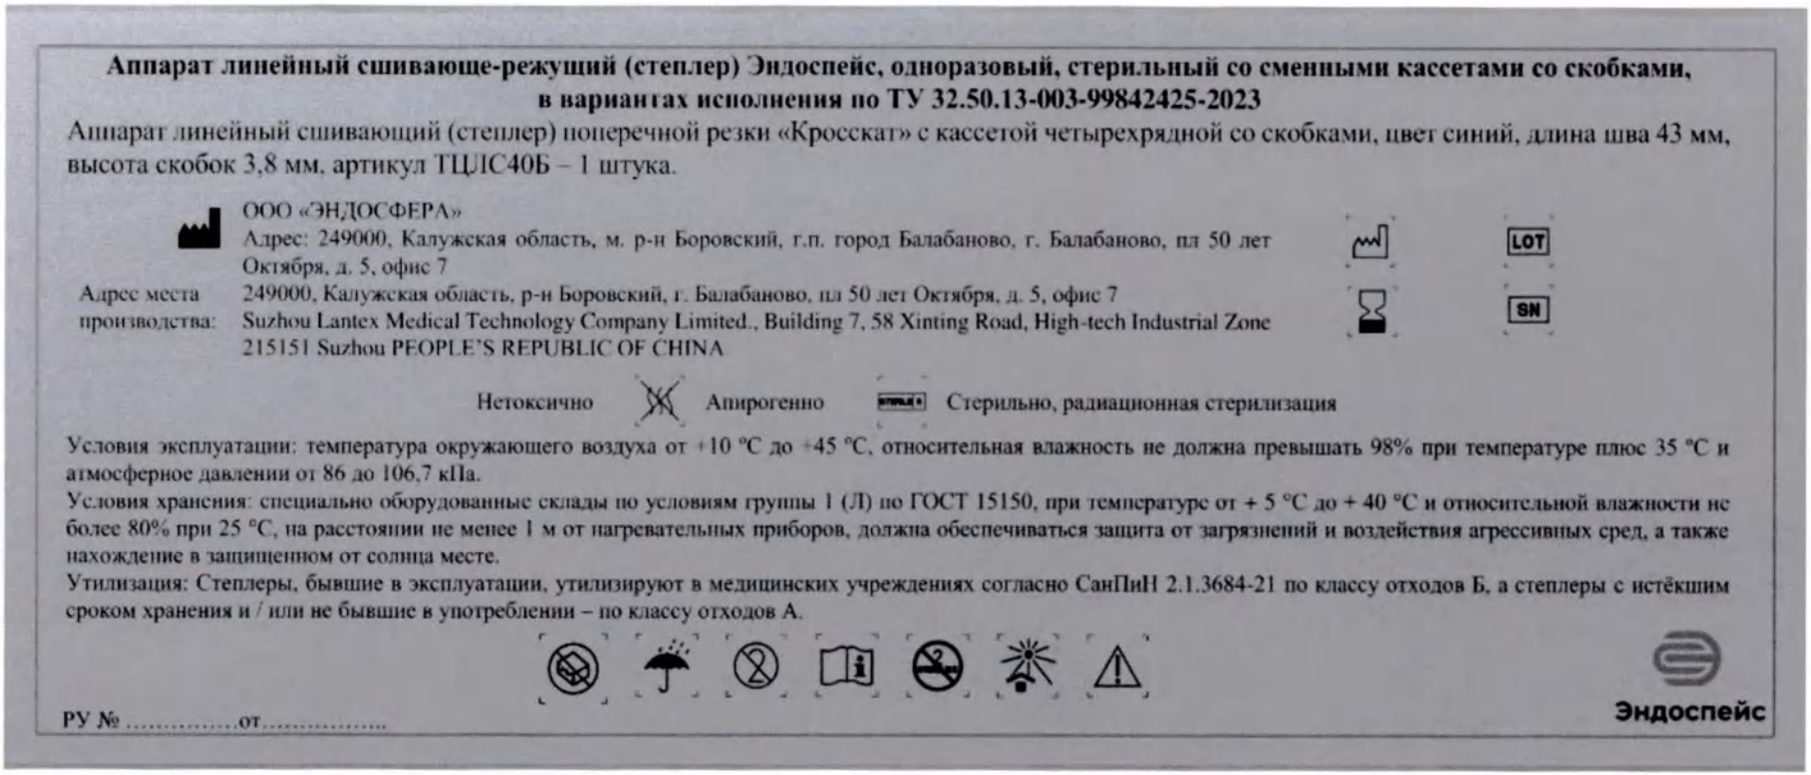

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 184А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

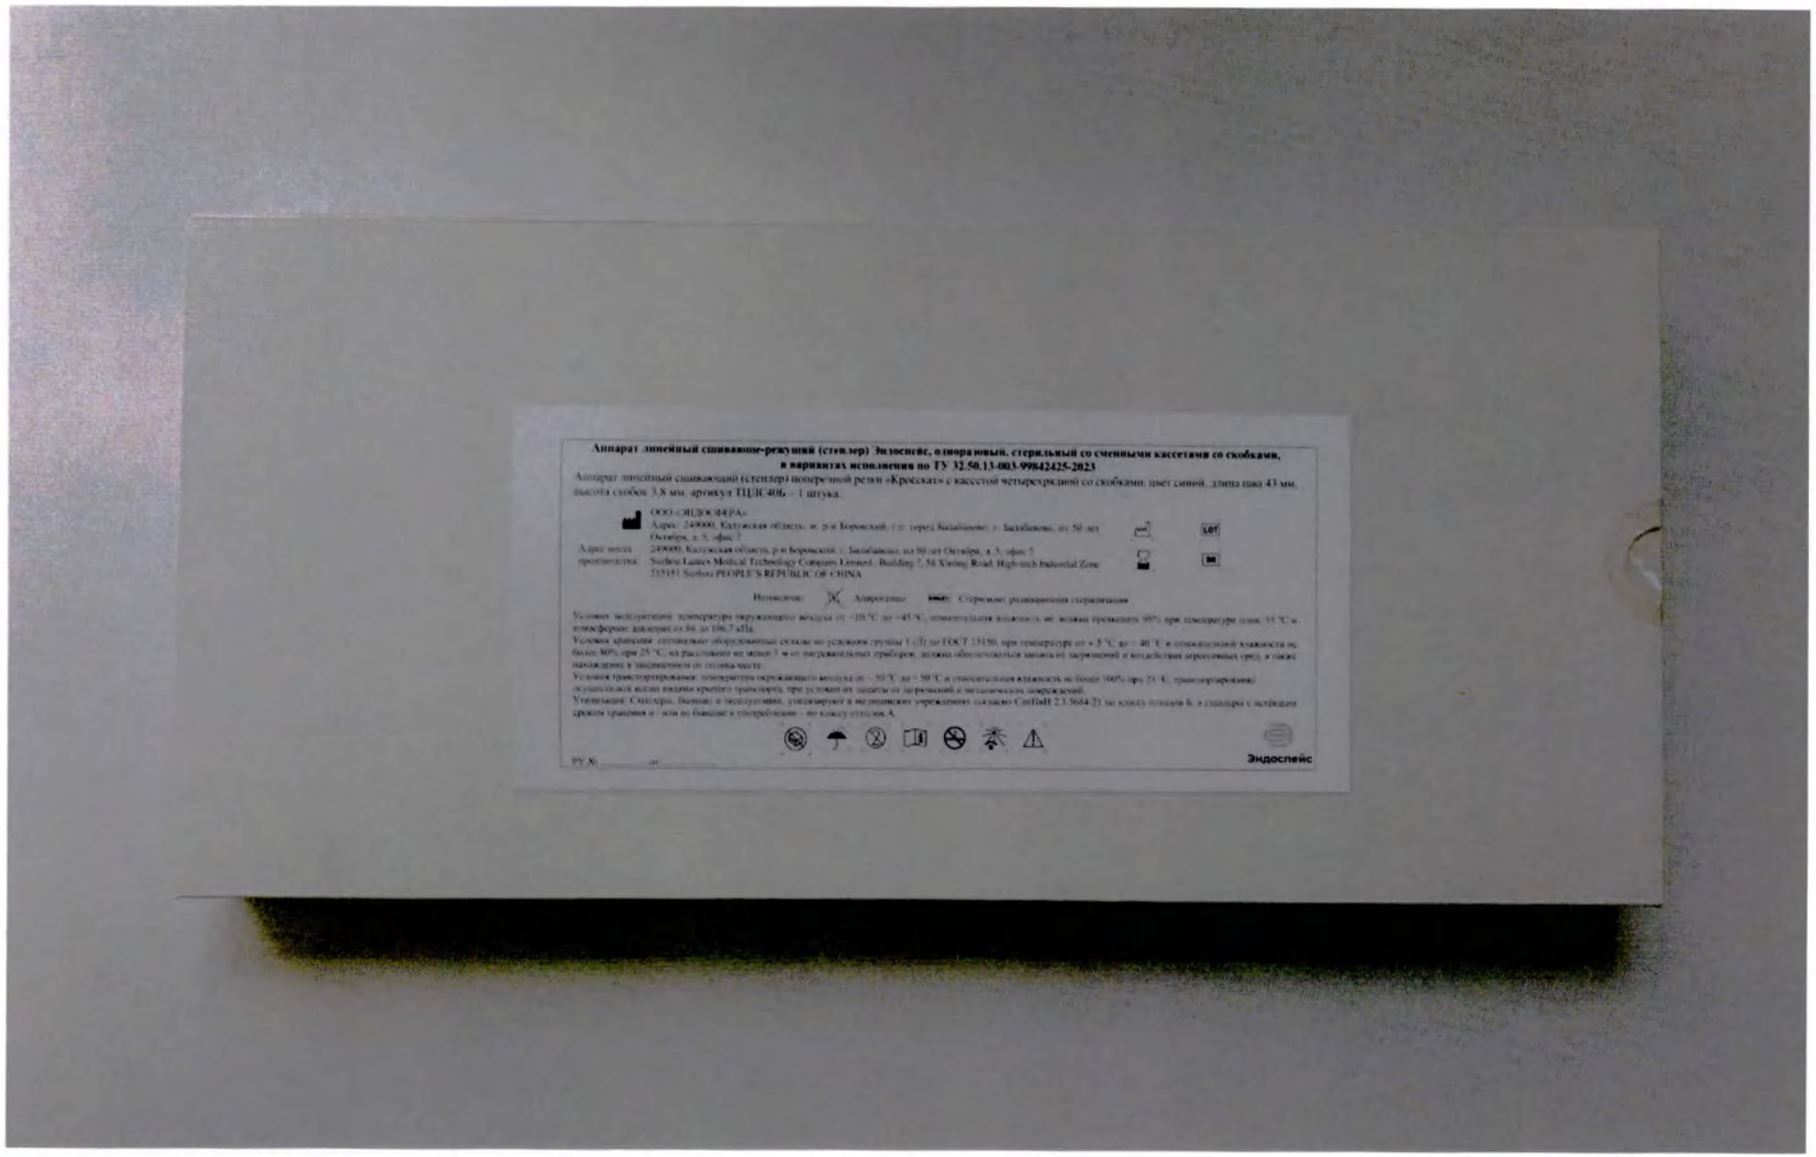

Рисунок 185 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 185А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 186 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

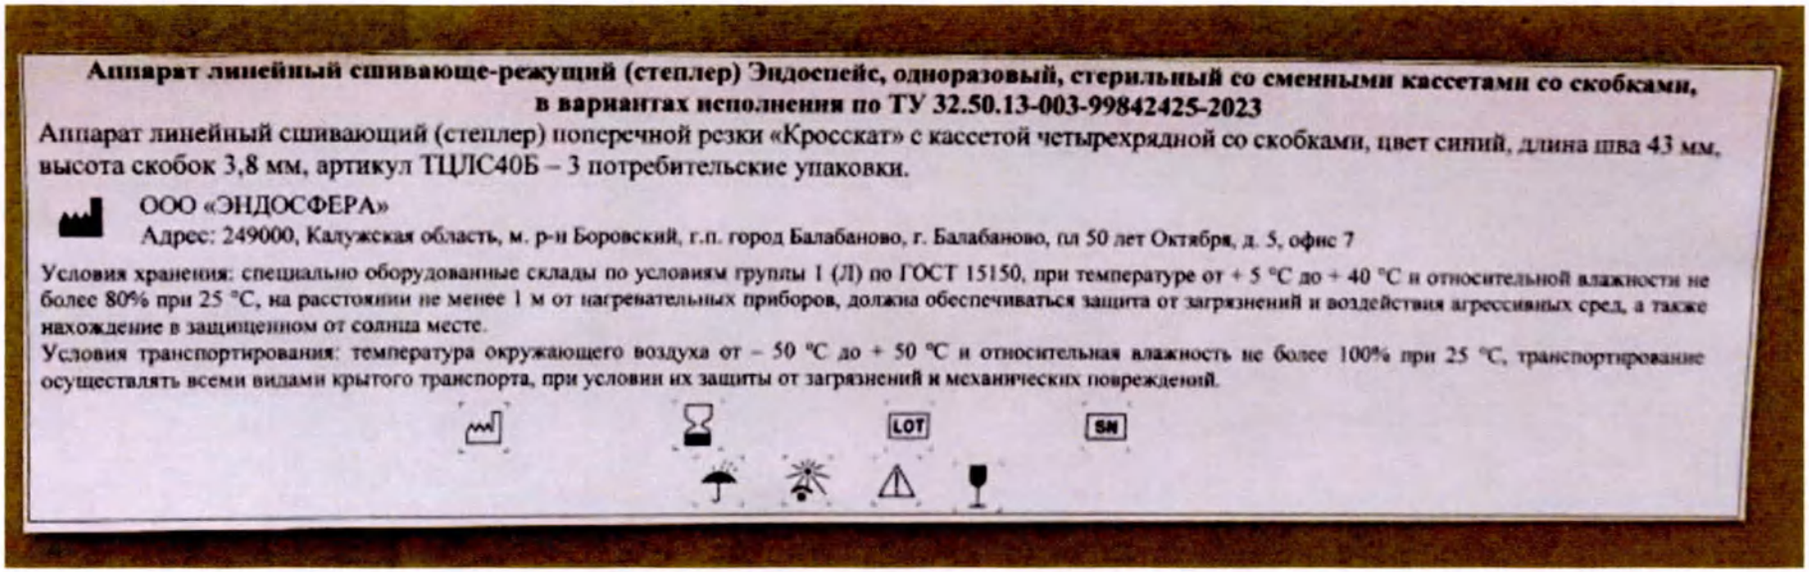

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Рисунок 186А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 43 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС40Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

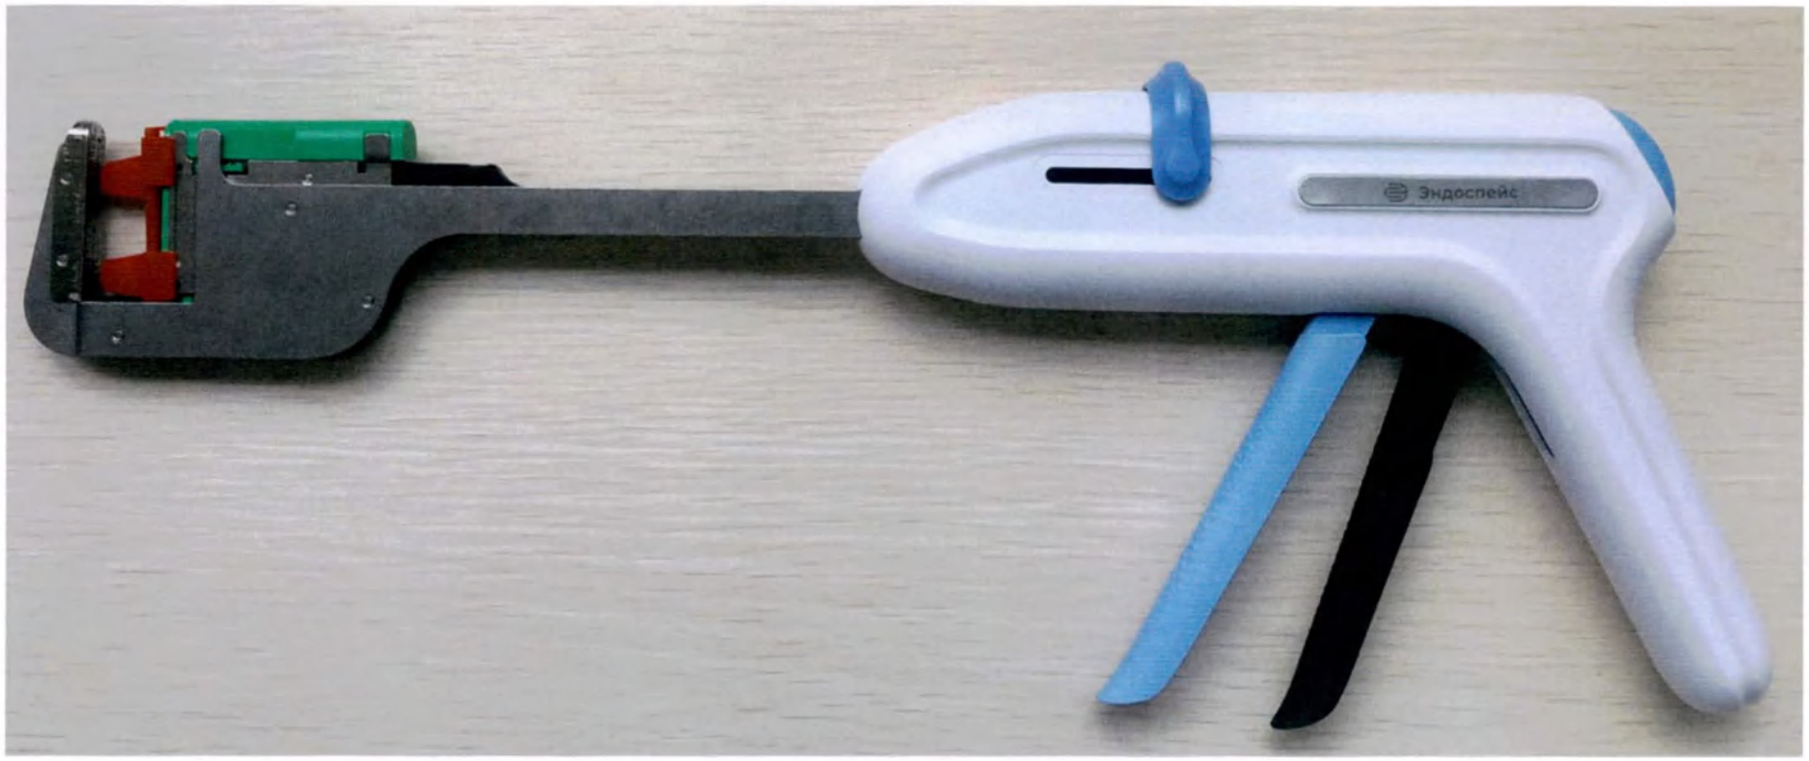

Рисунок 187 – Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 188 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 188А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 189 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

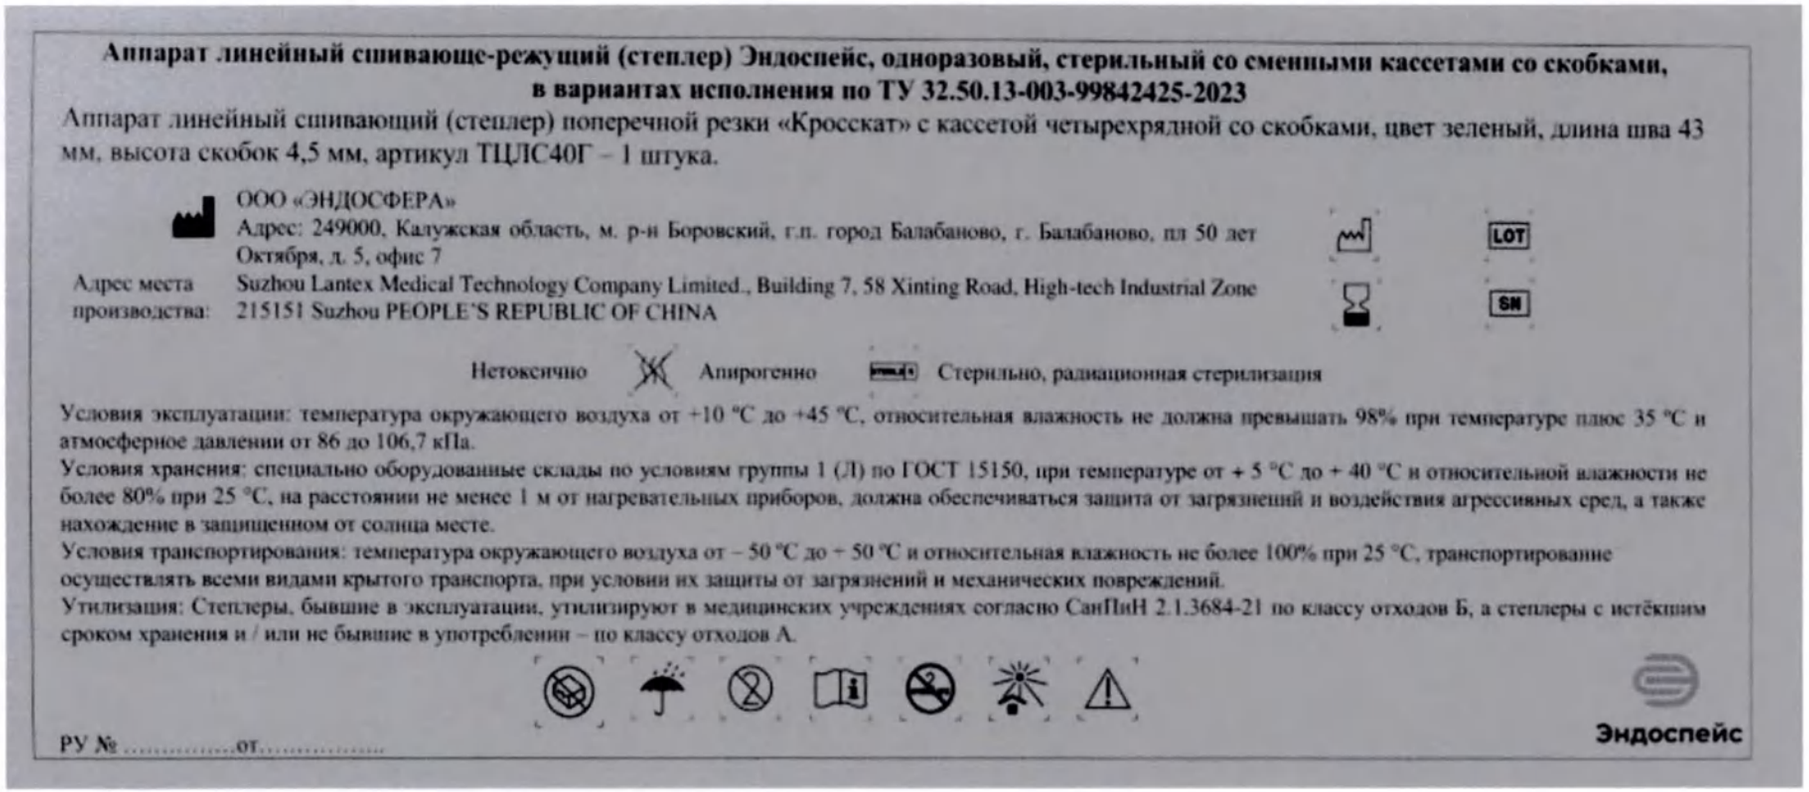

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 189А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

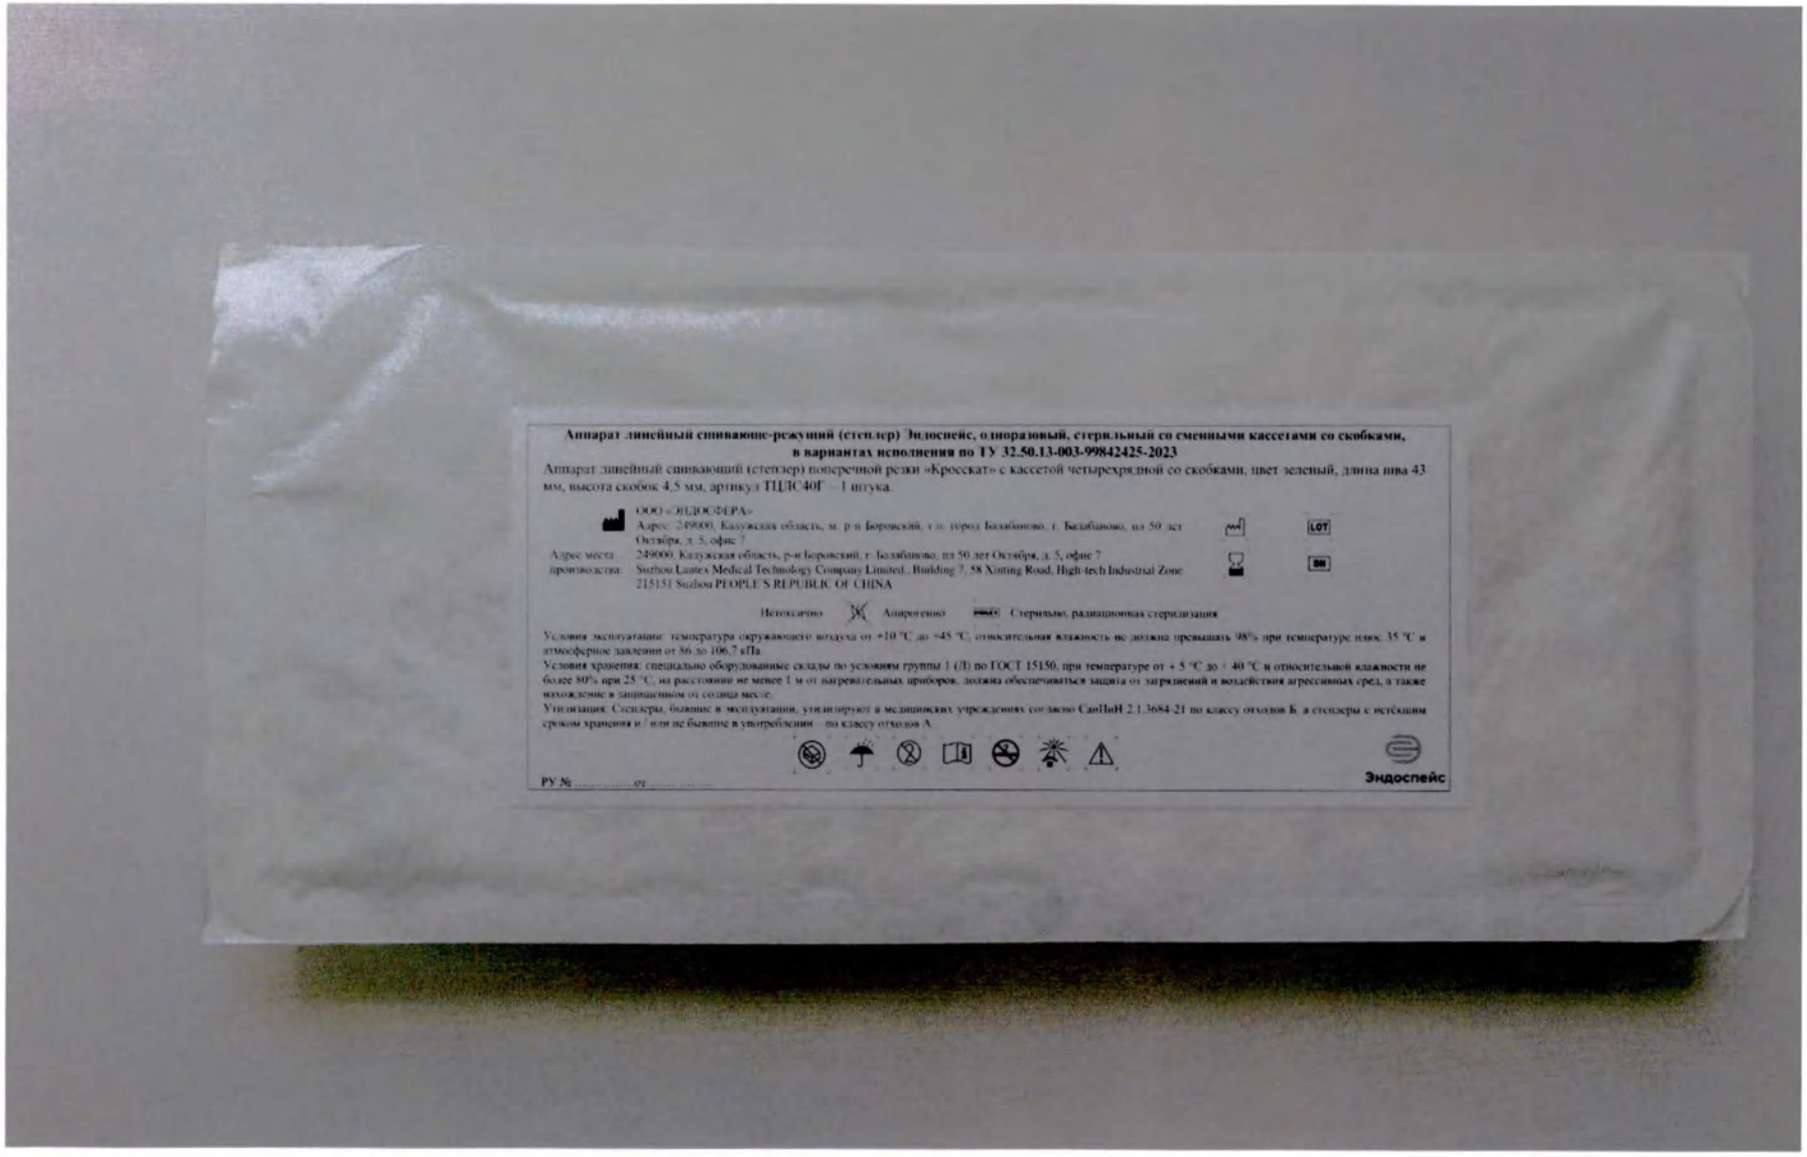

Рисунок 190 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 190А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 191 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

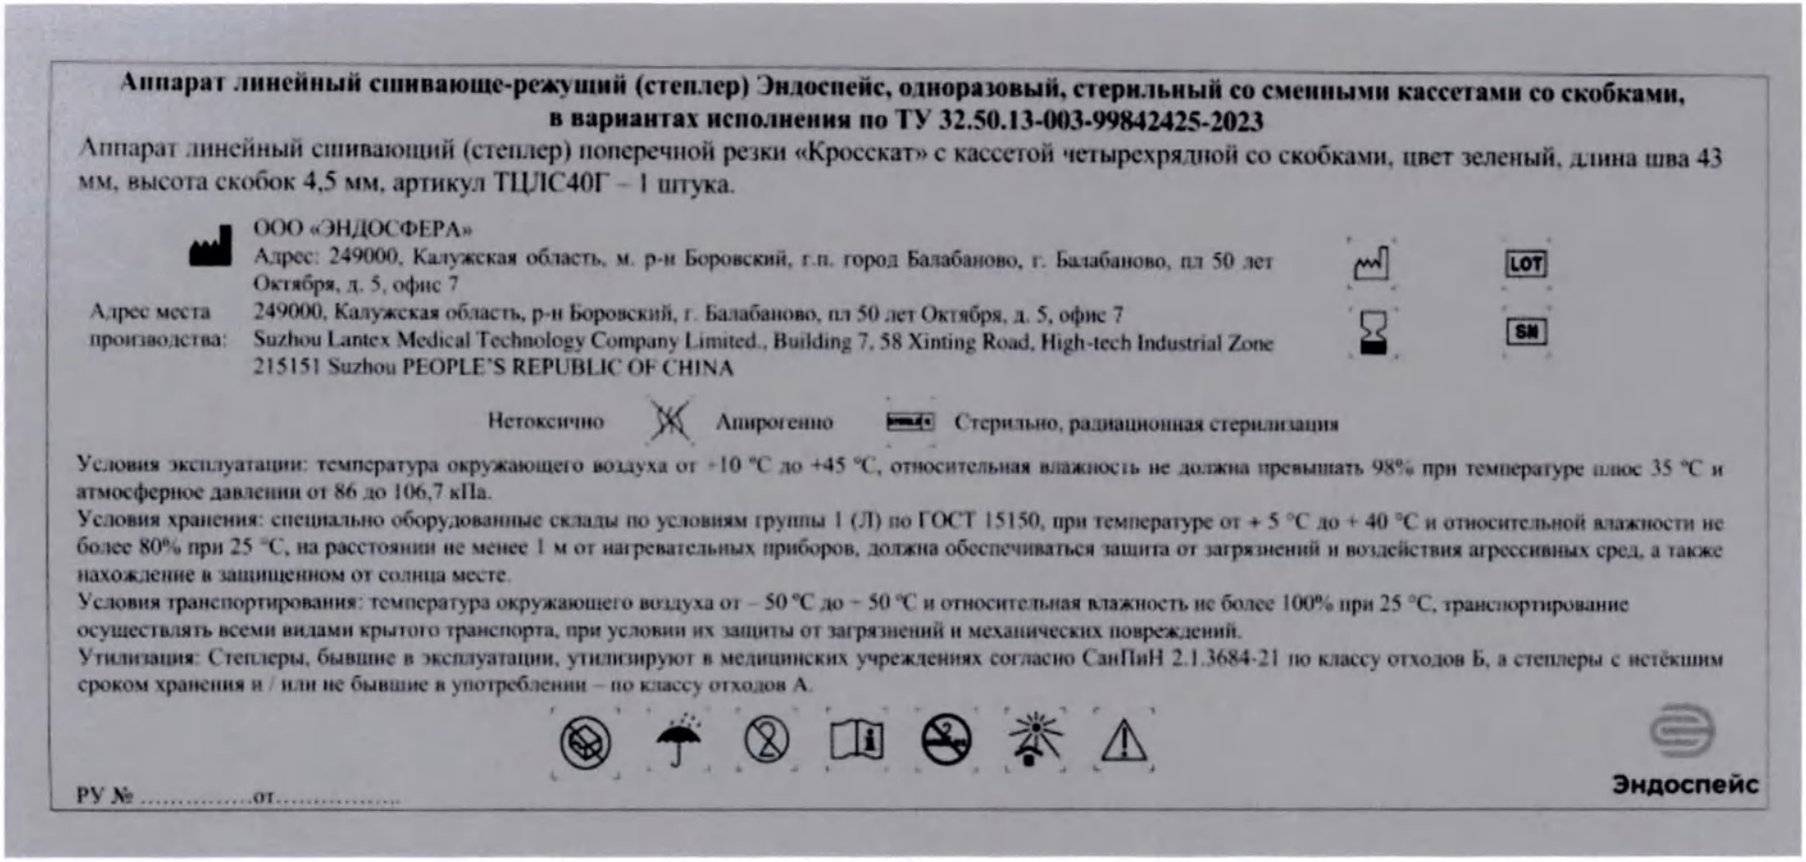

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.
Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 191А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 192 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

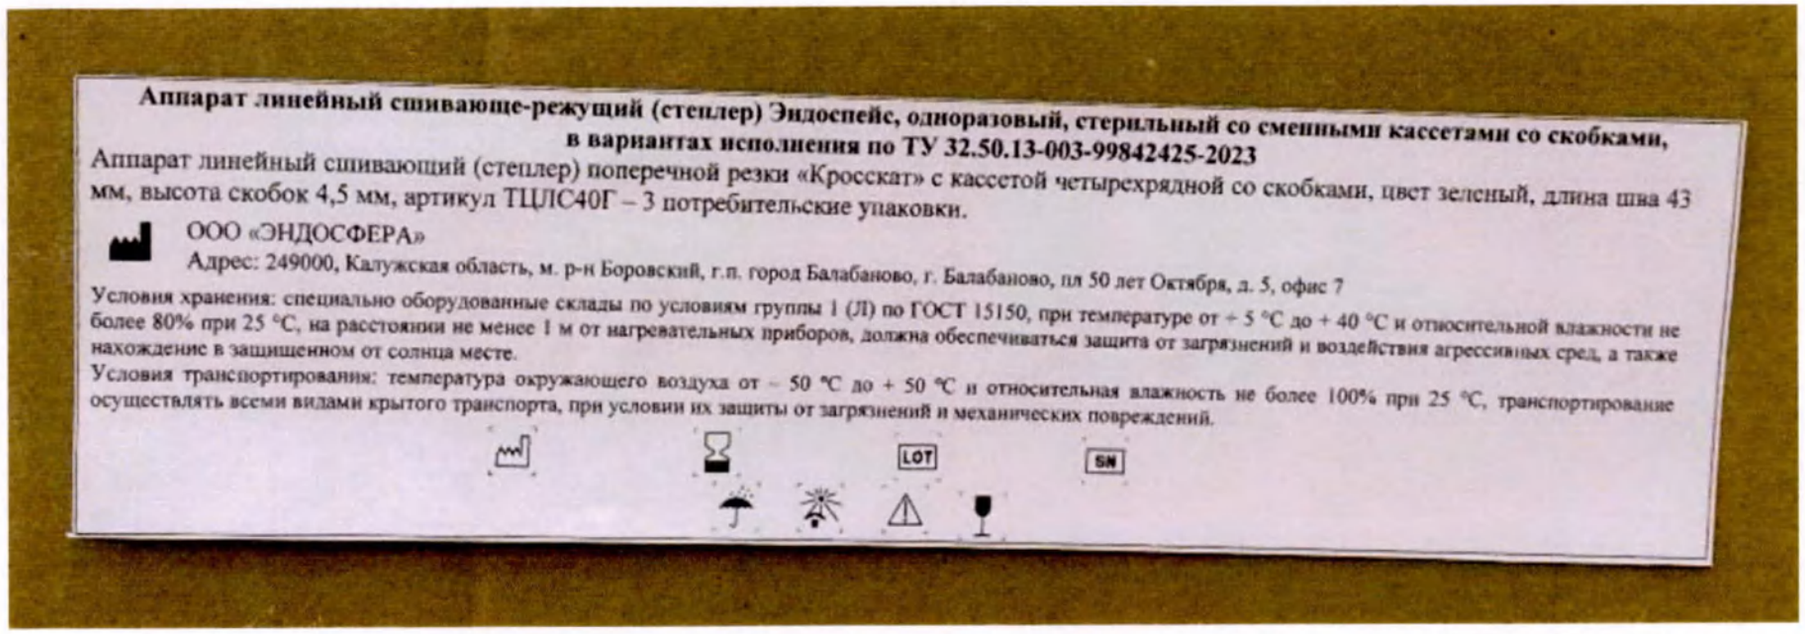

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

LOT SN

Рисунок 192А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 43 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС40Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

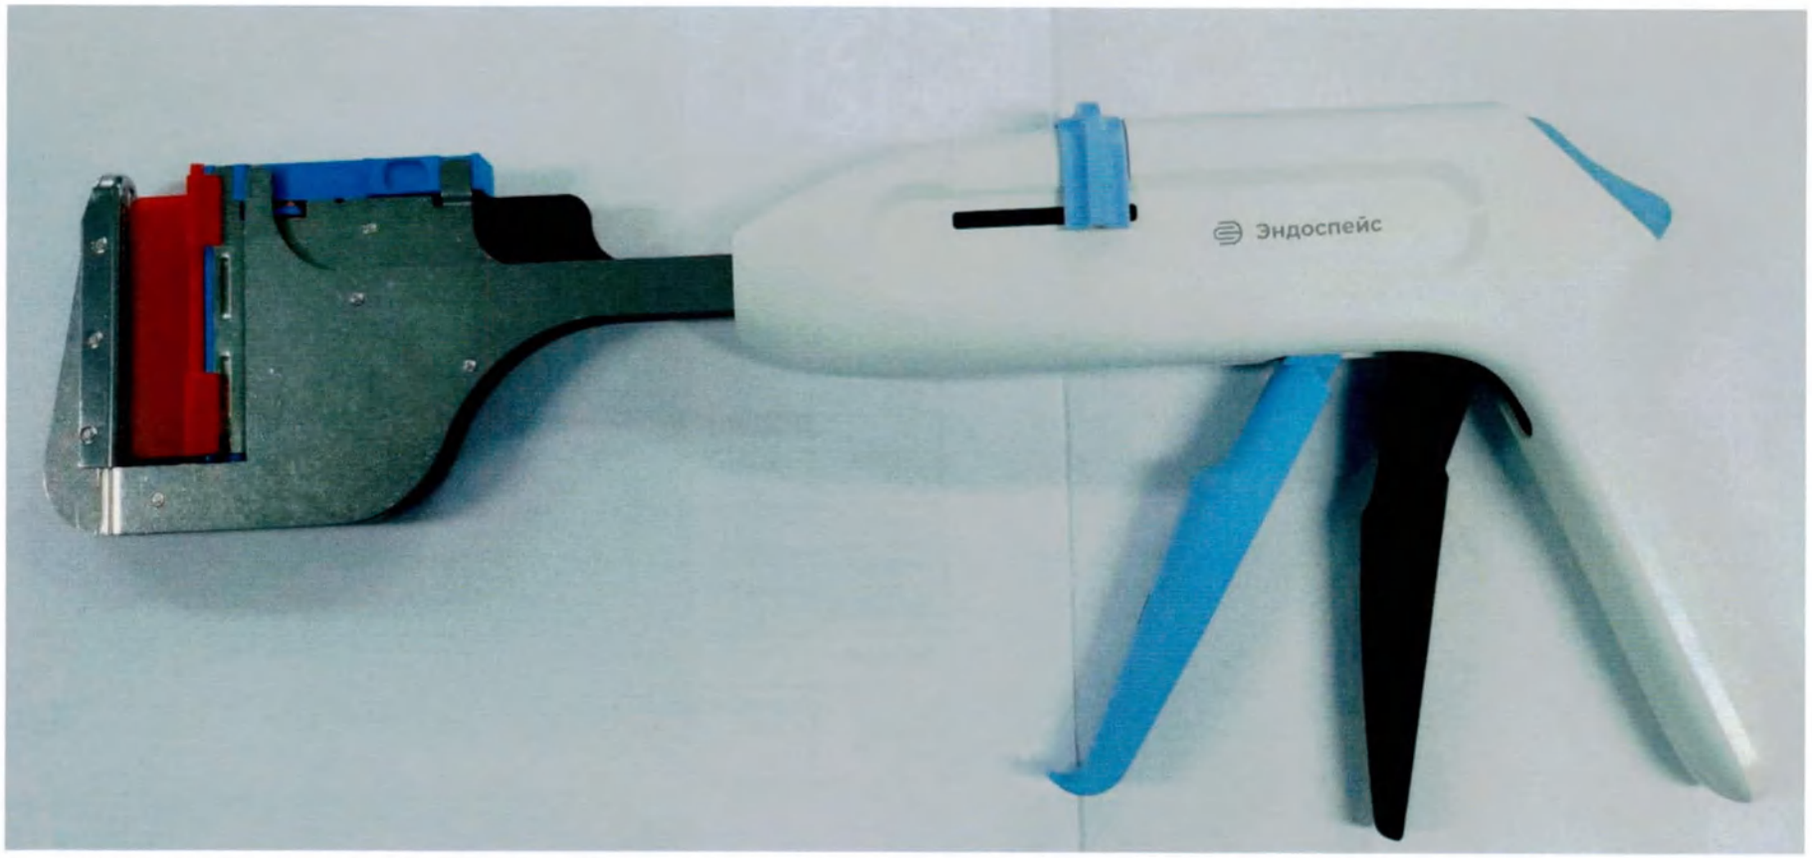

Рисунок 193 – Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

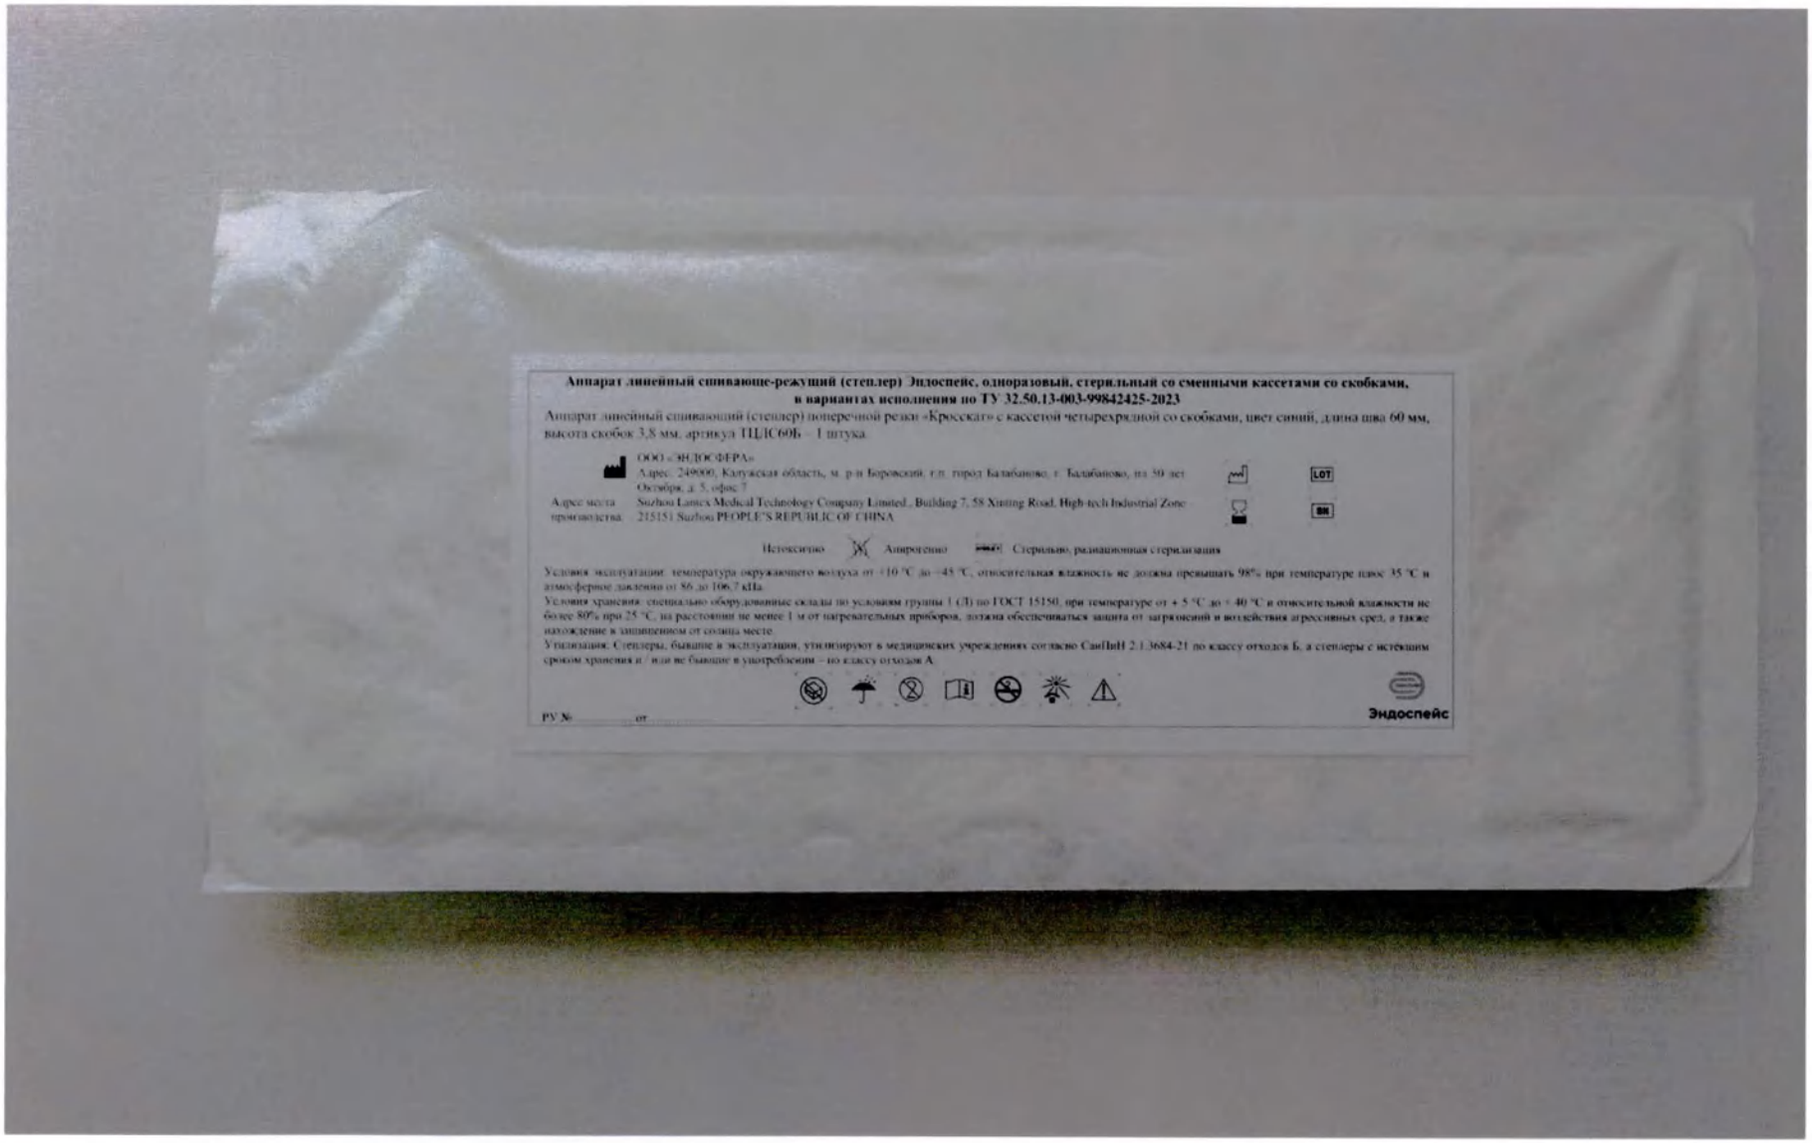

Рисунок 194 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

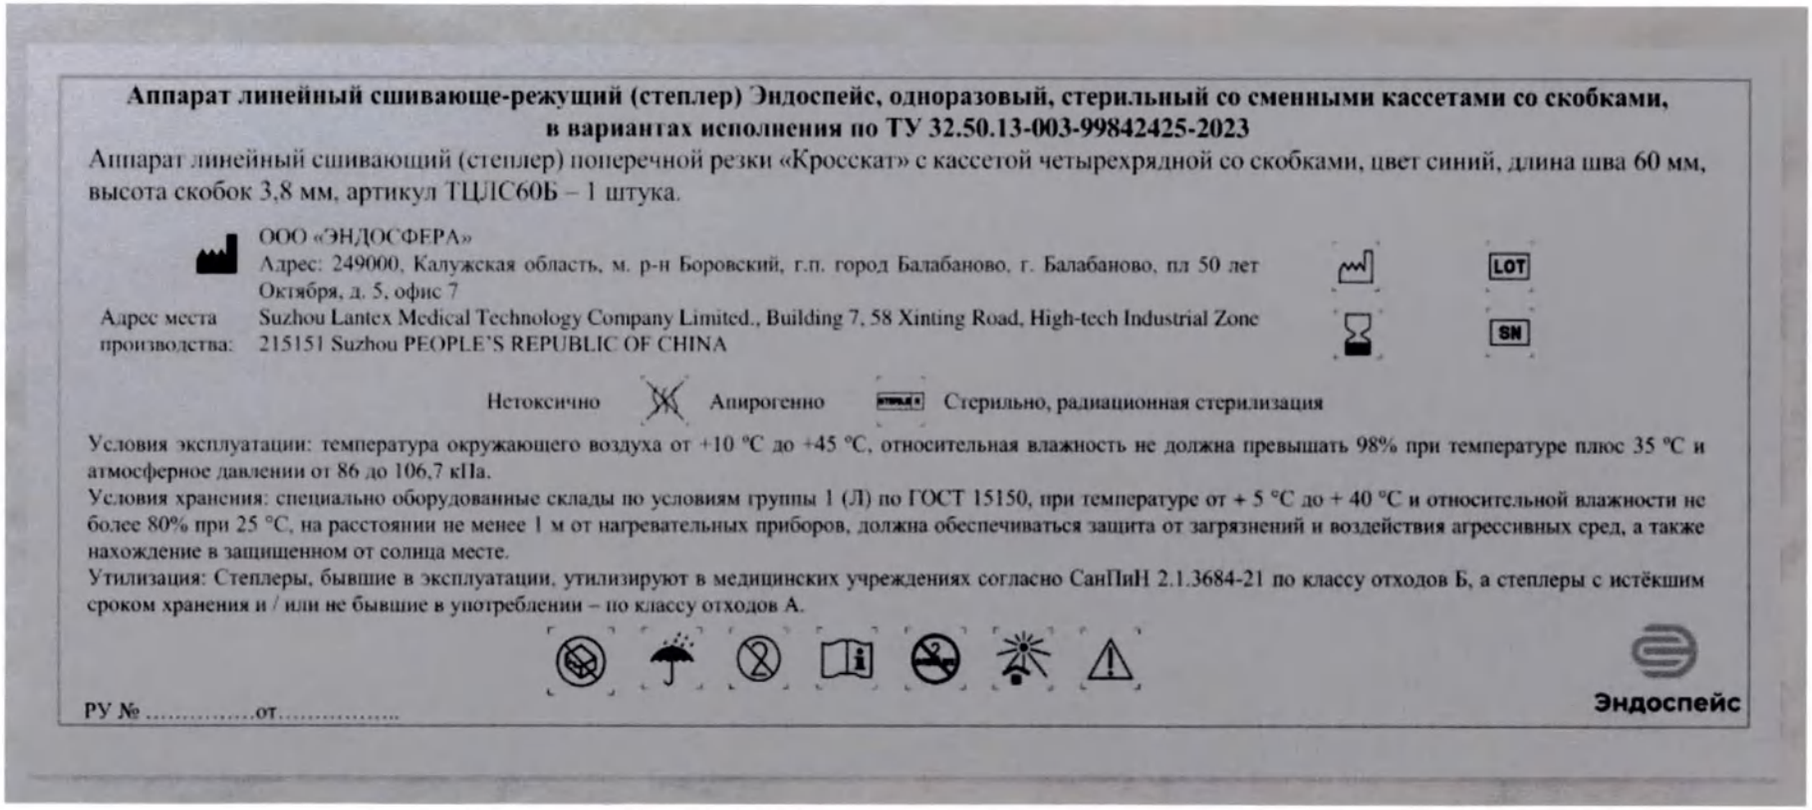

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 194А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 195 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

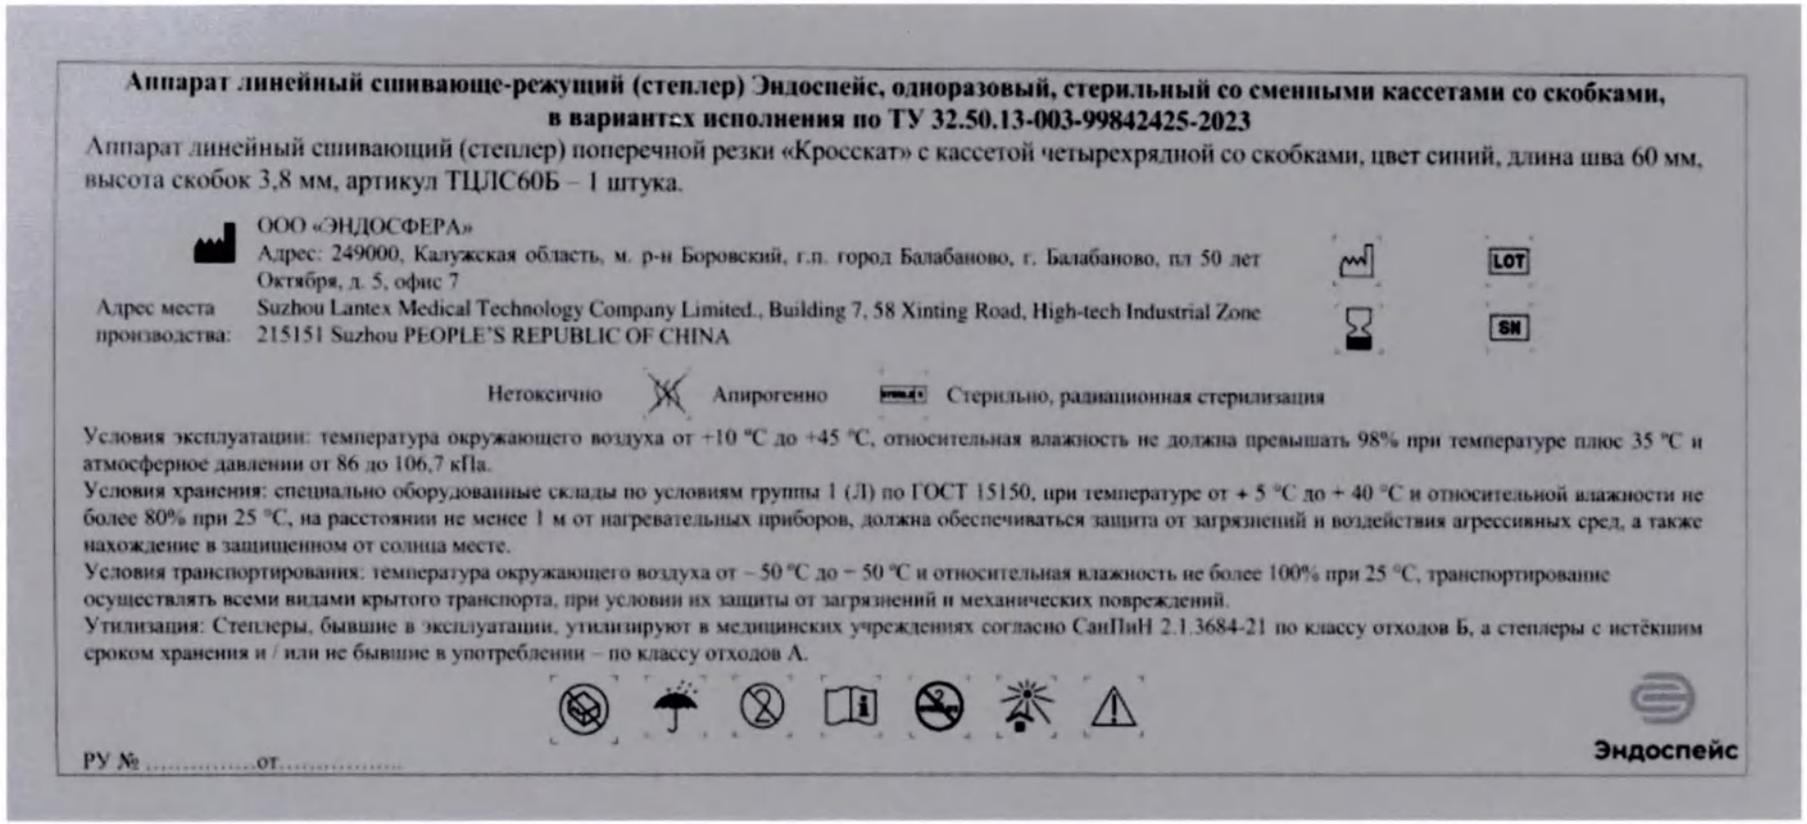

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 195А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 196 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 196А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

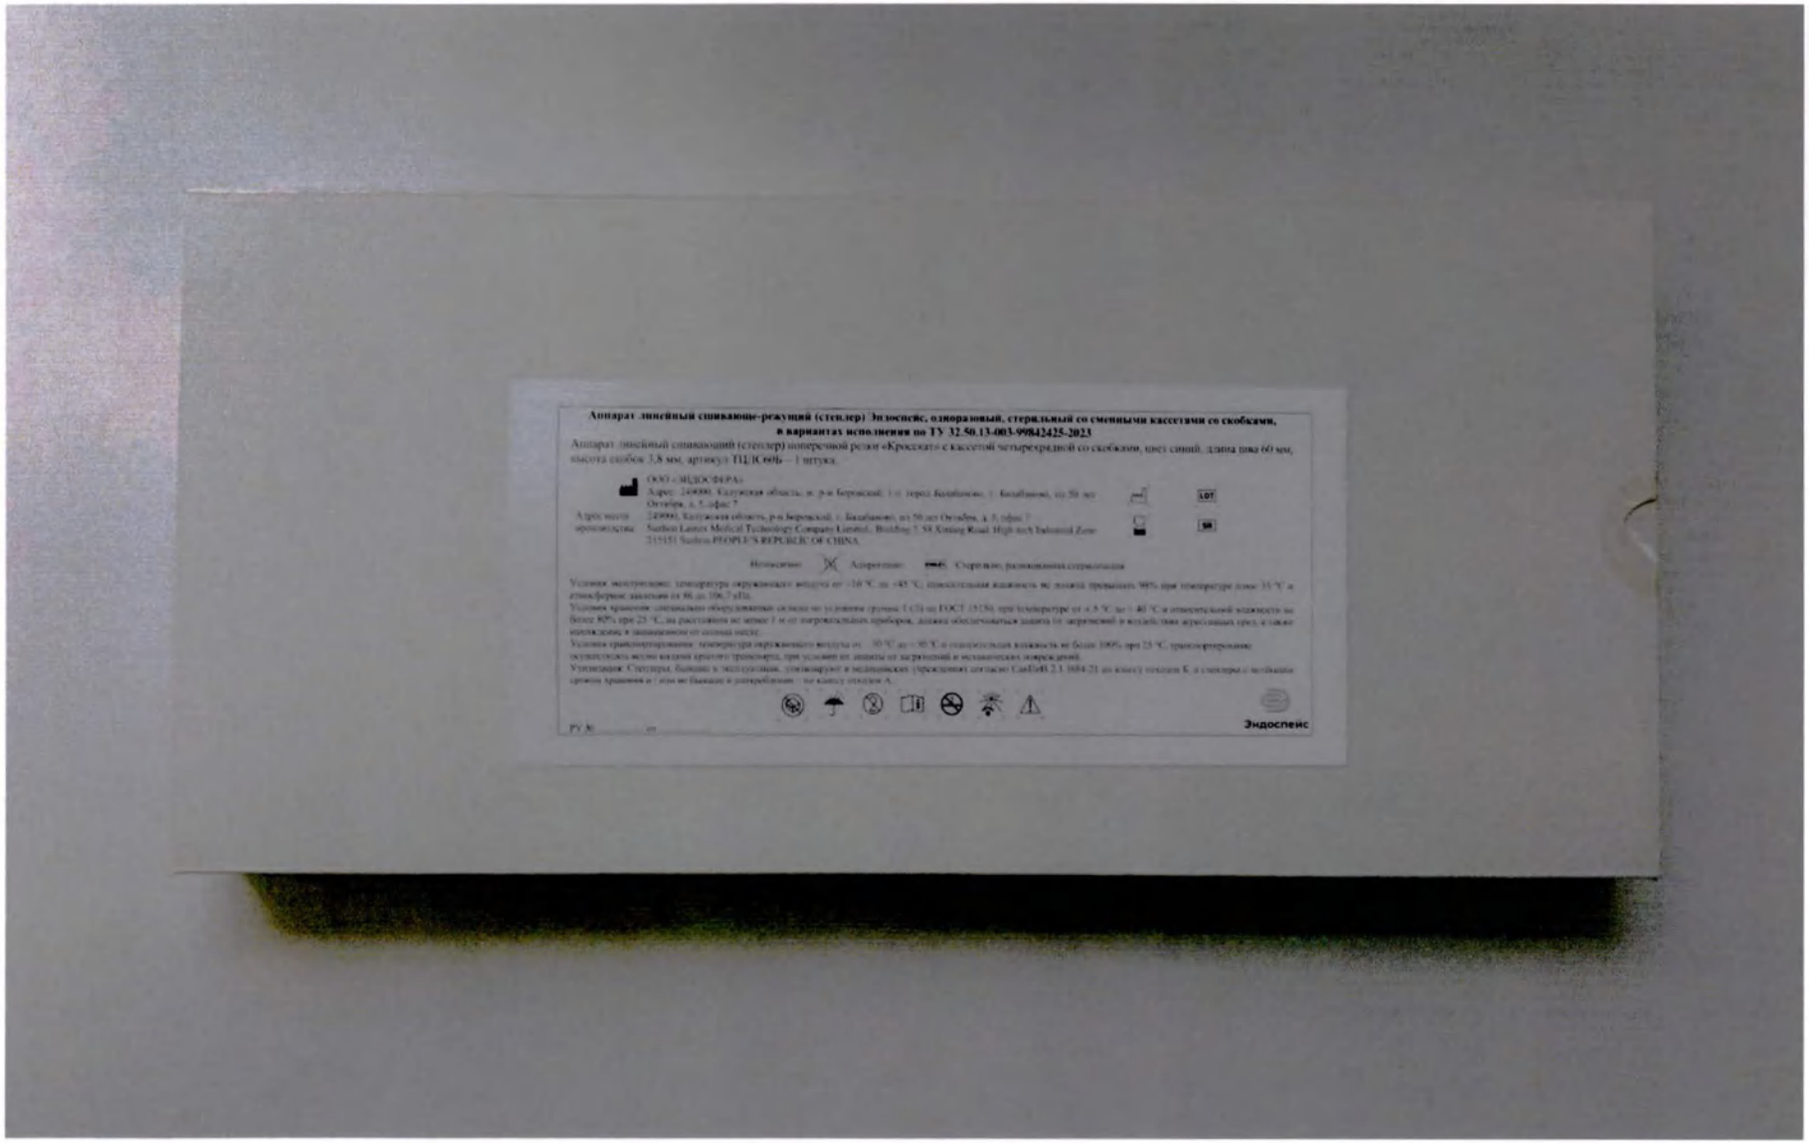

Рисунок 197 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

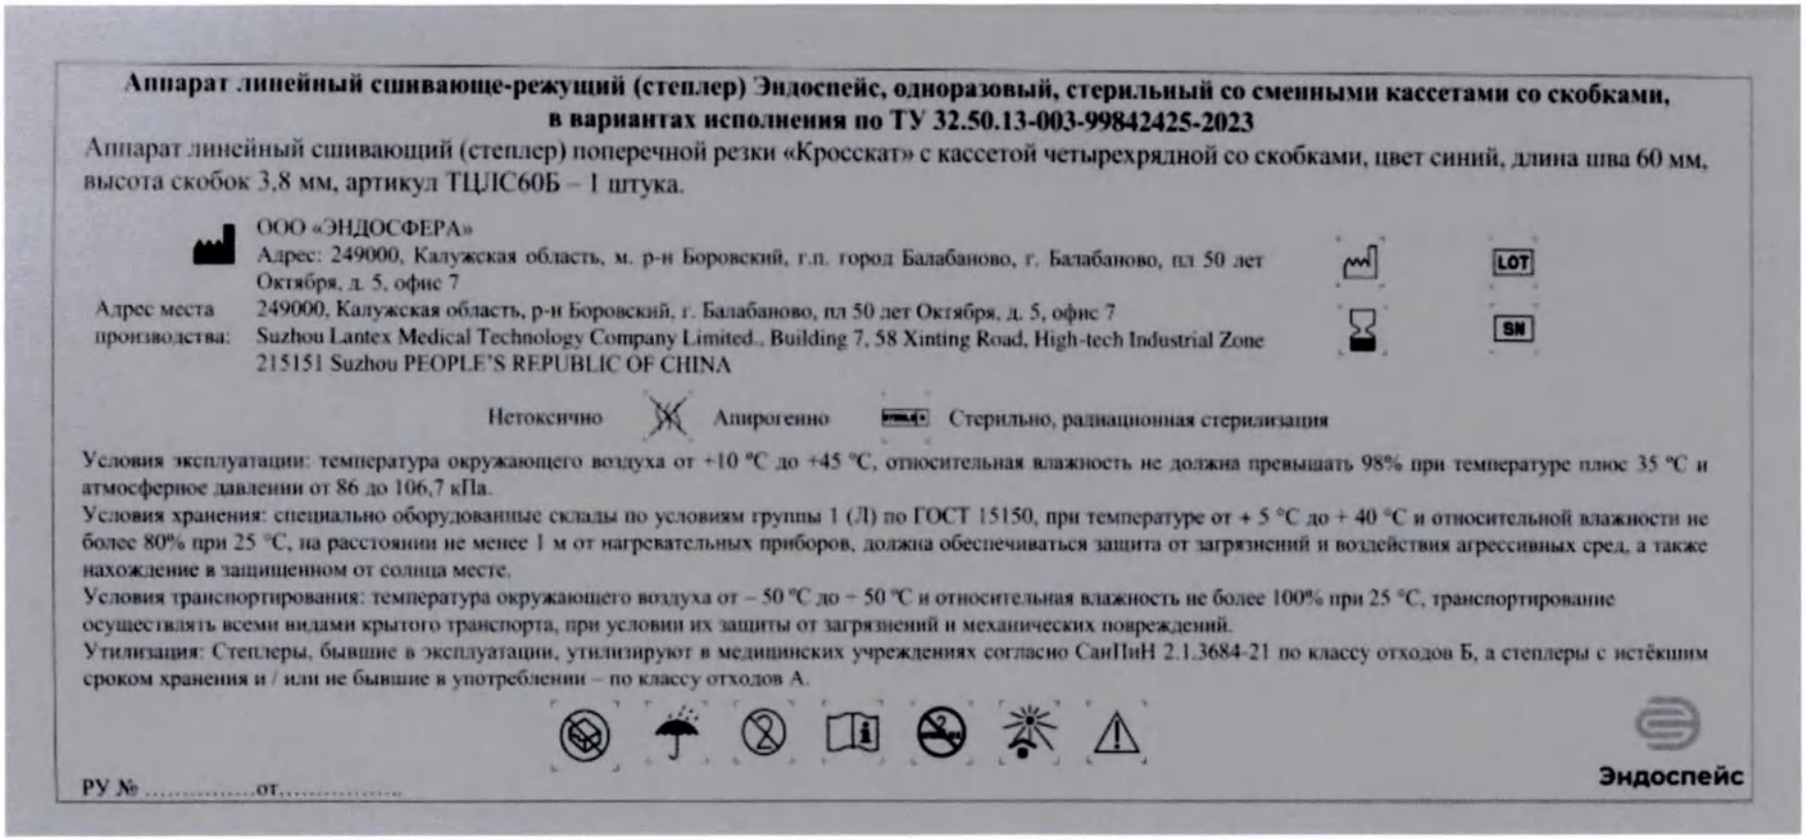

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 197А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

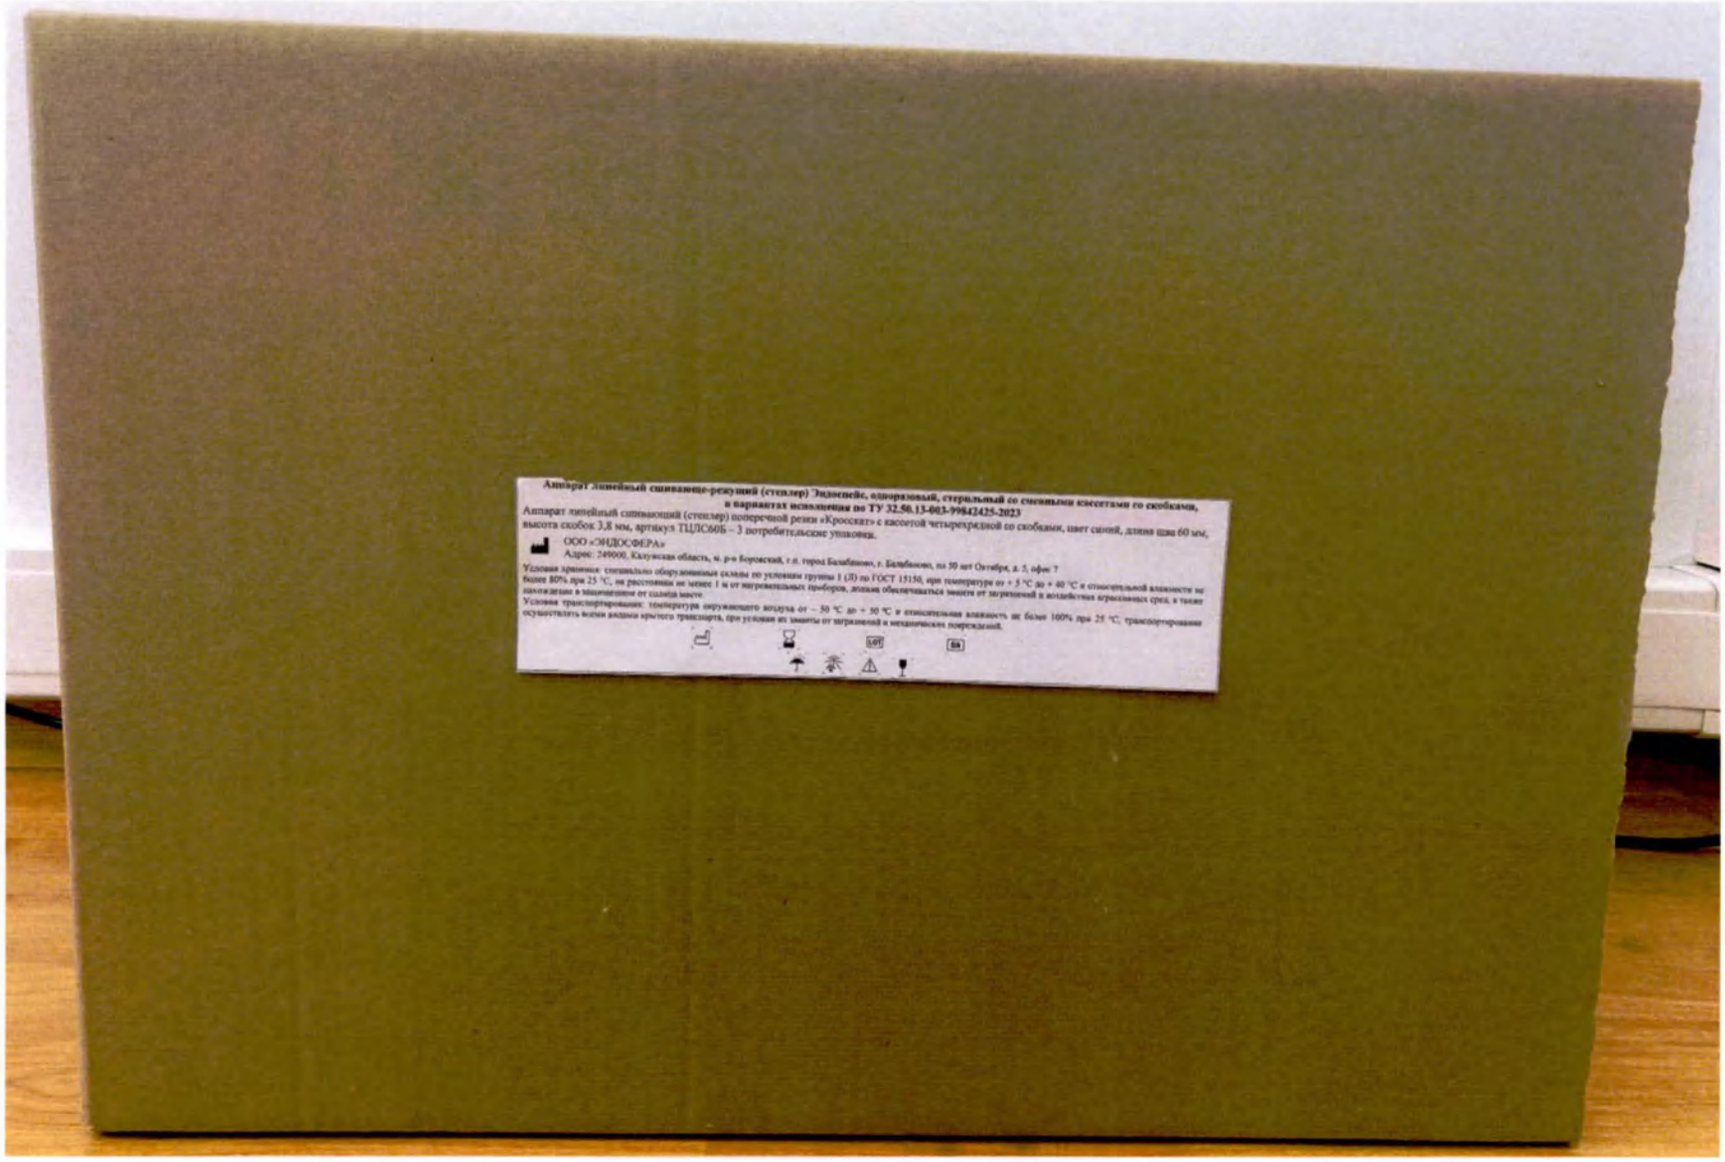

Рисунок 198 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

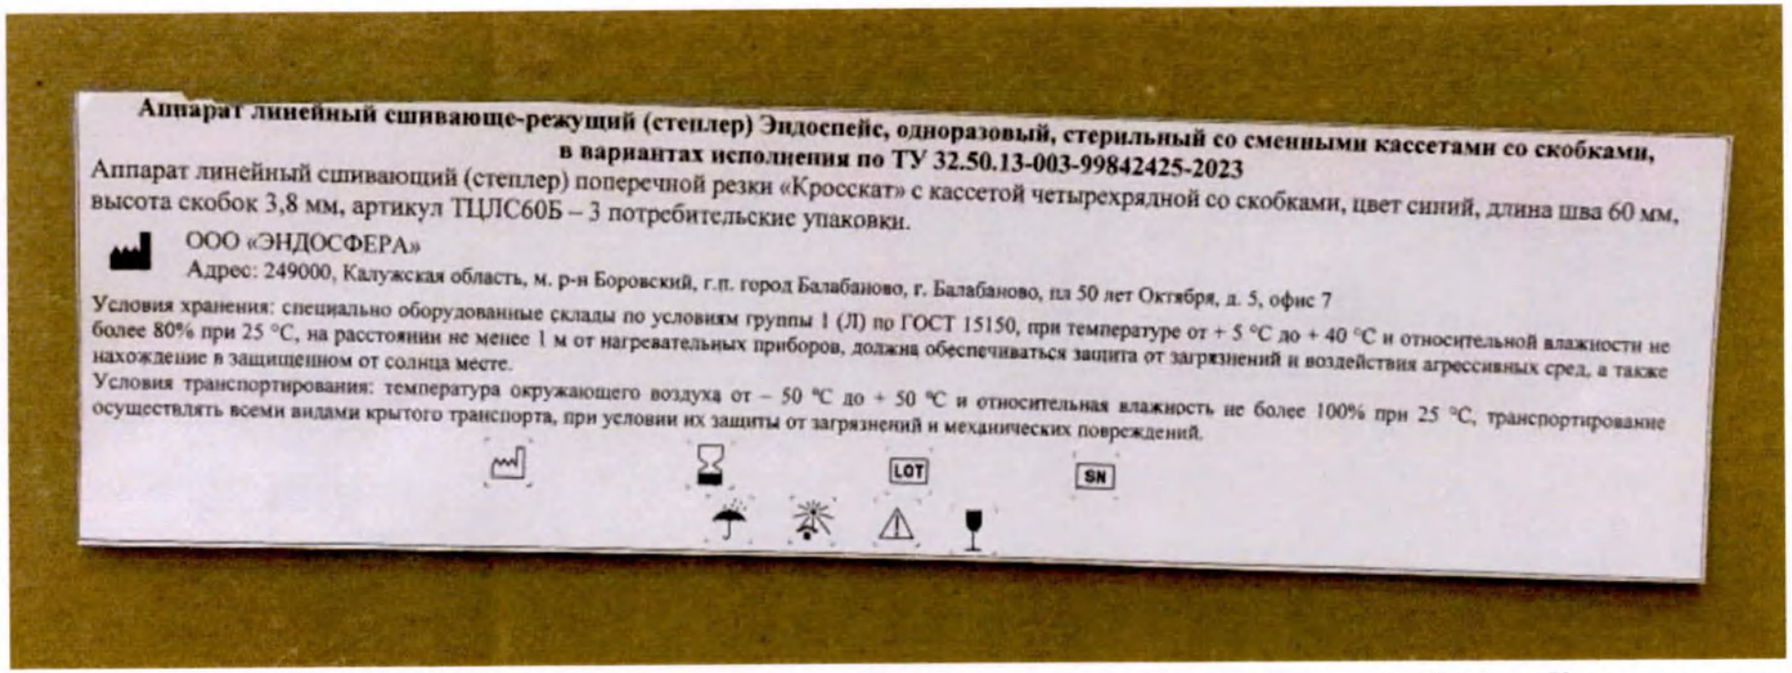

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

LOT

SN

Рисунок 198А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул ТЦЛС60Б

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

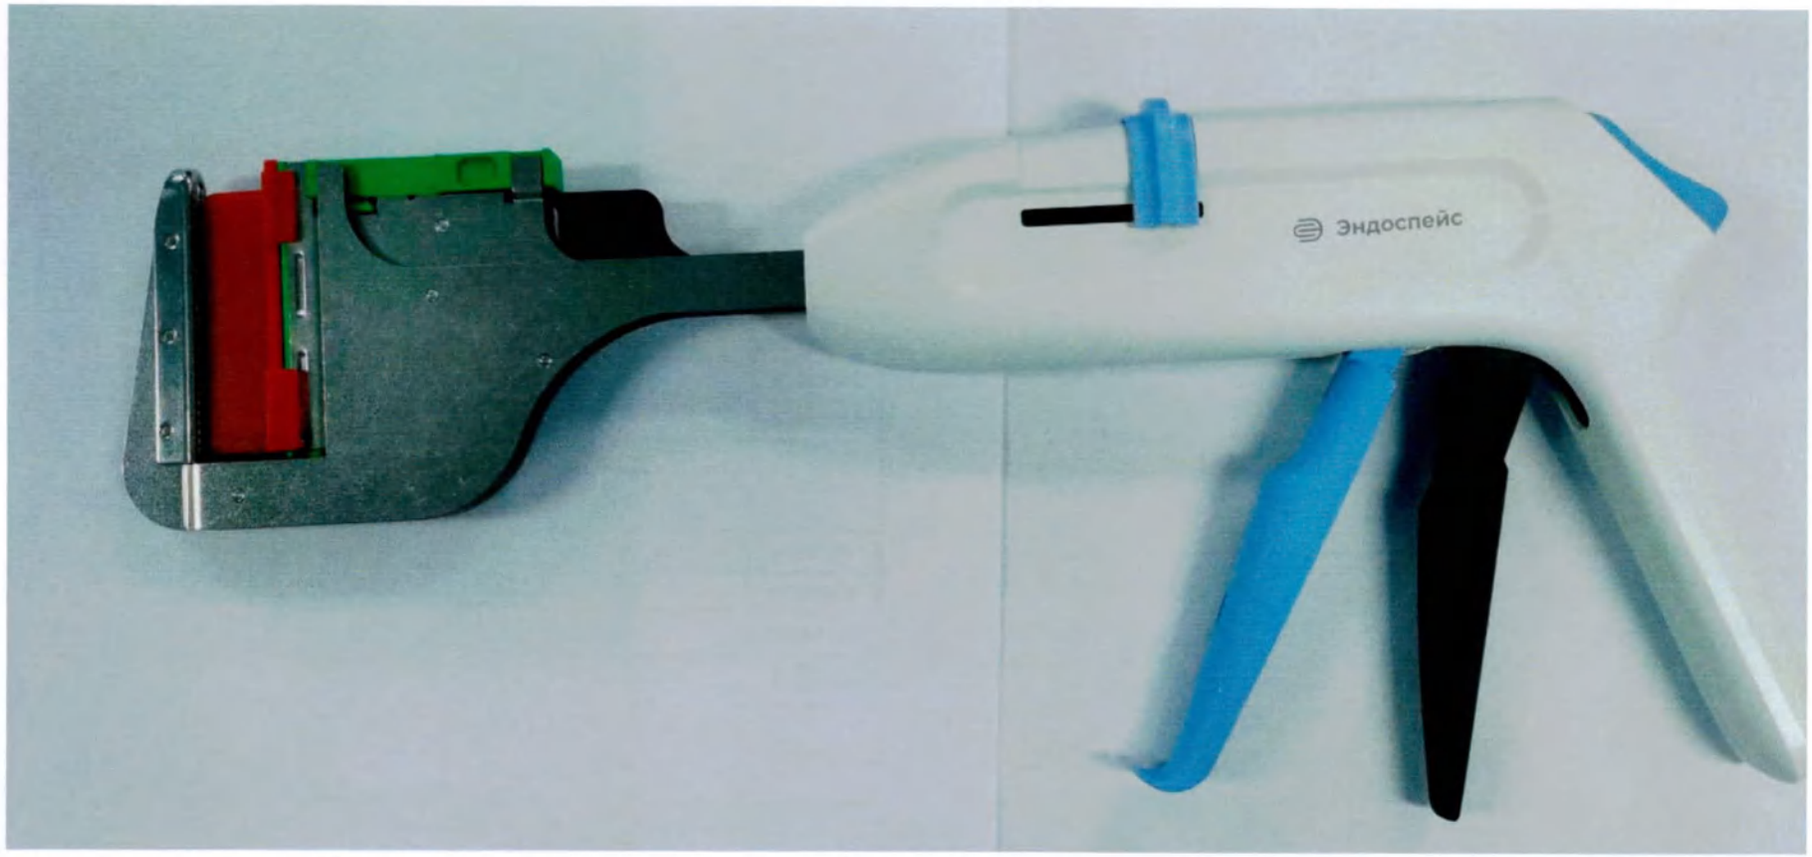

Рисунок 199 – Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 200 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

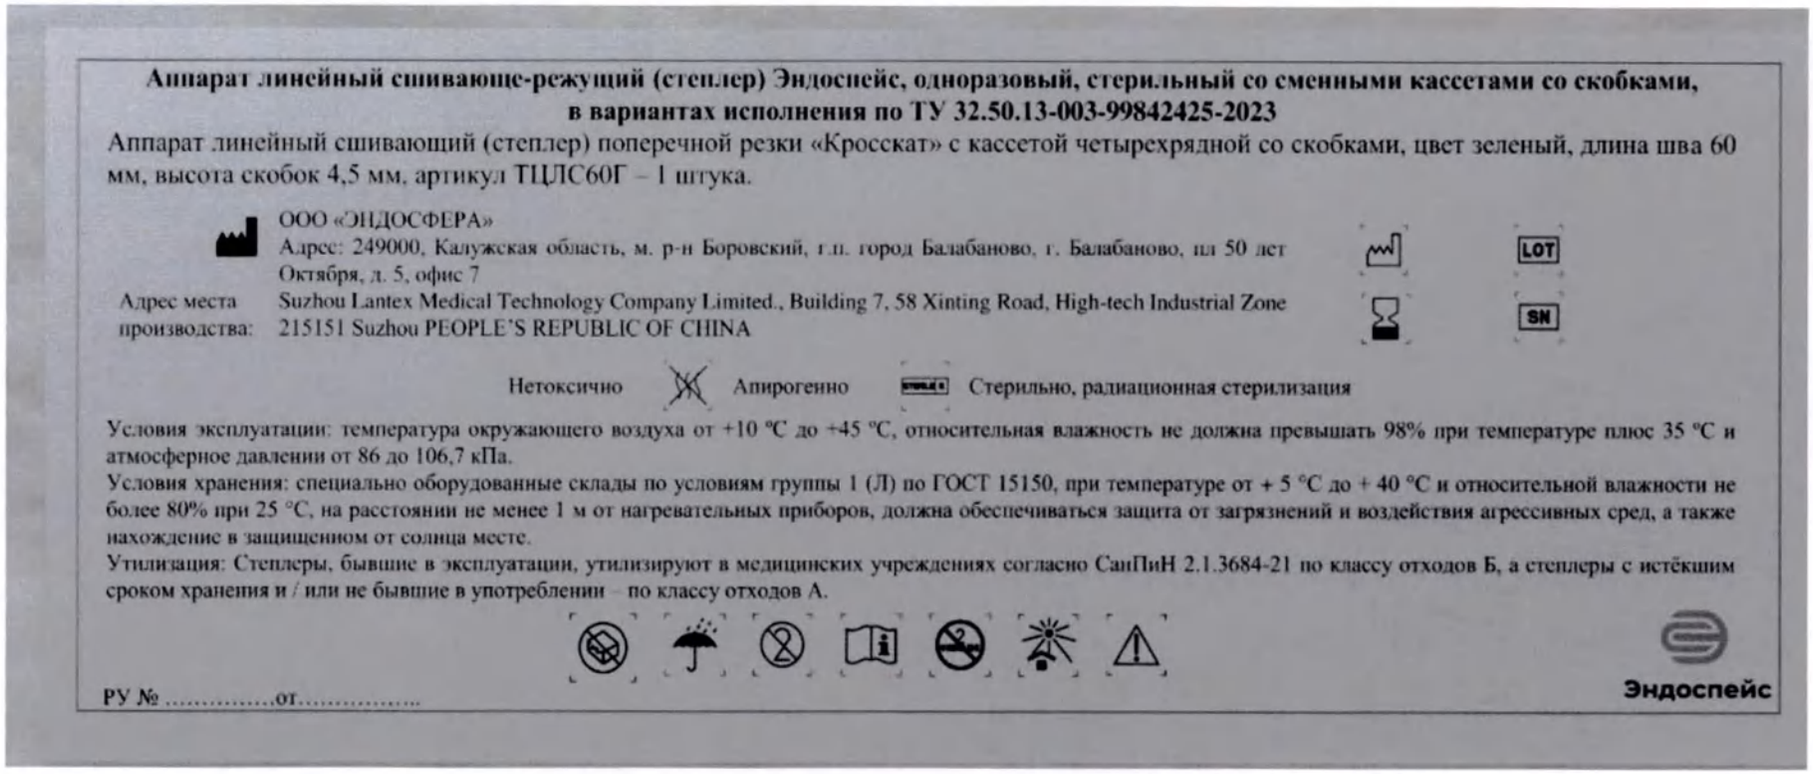

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 200А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

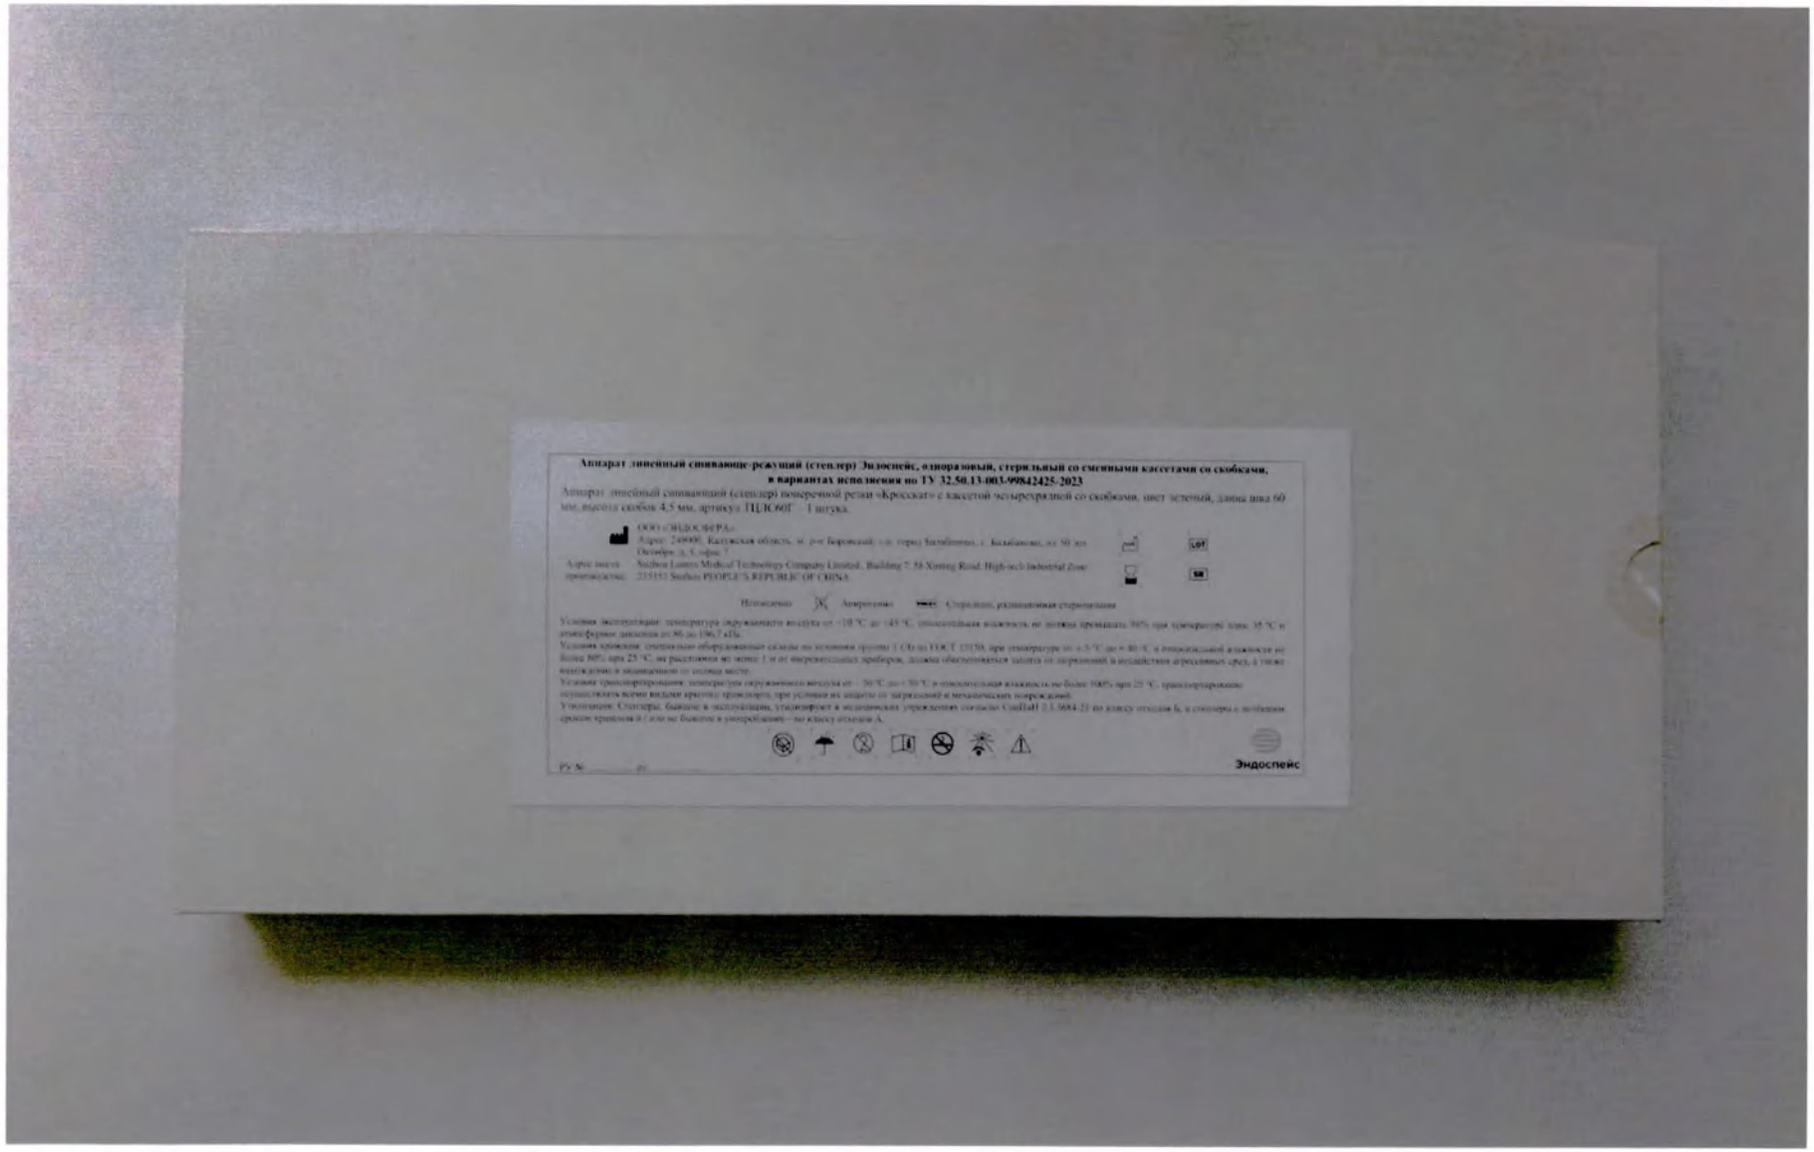

Рисунок 201 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

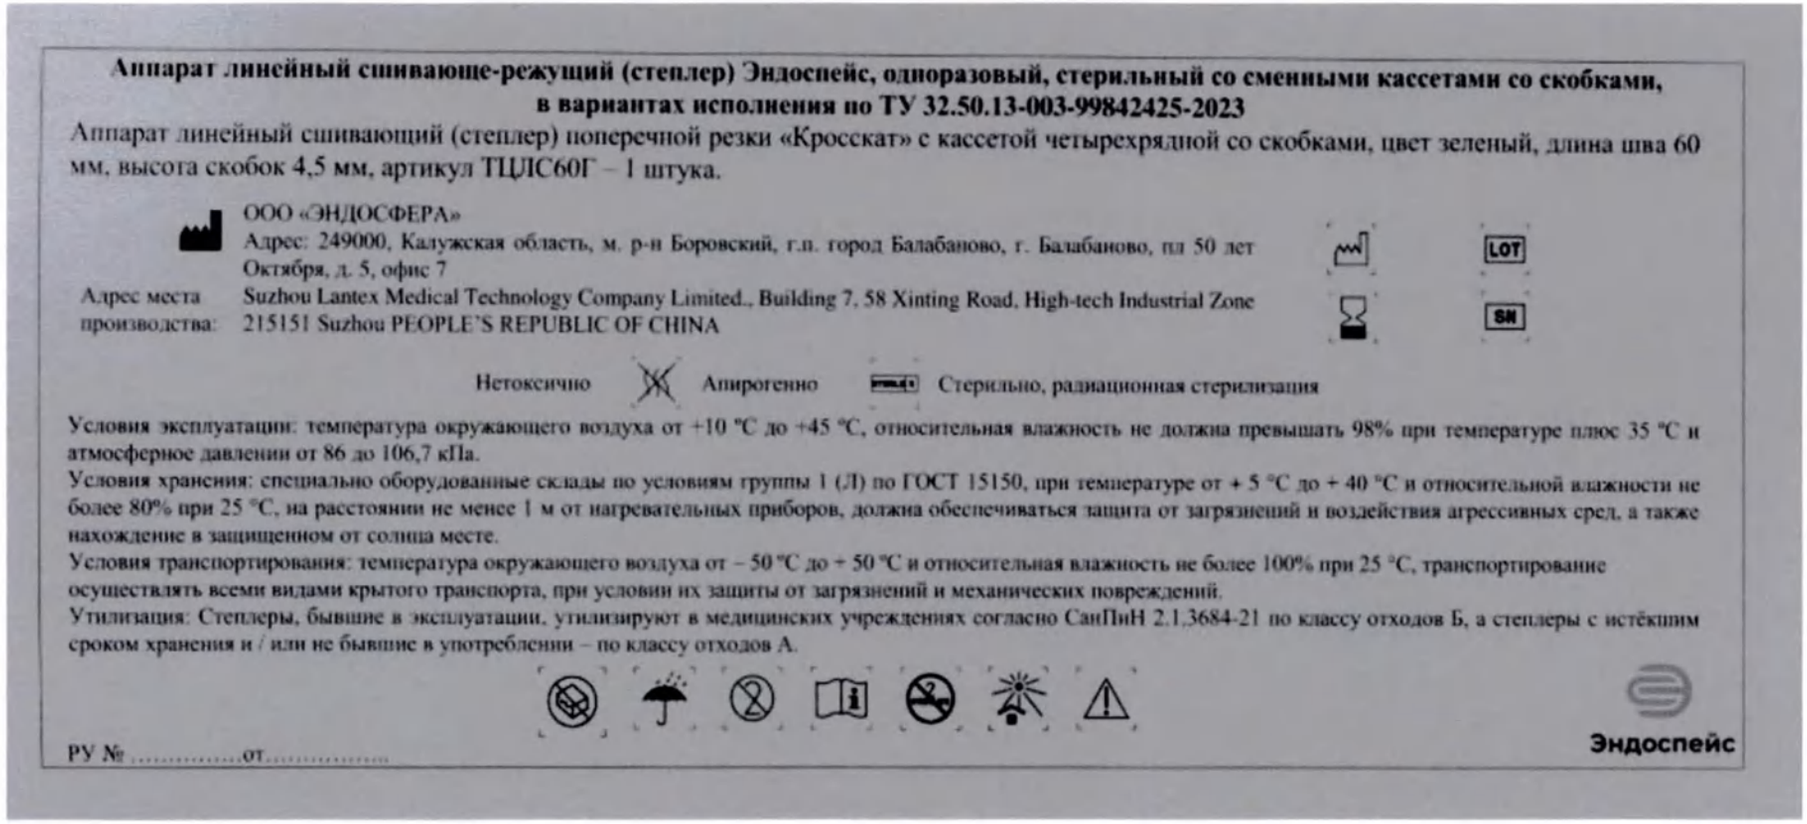

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 201А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

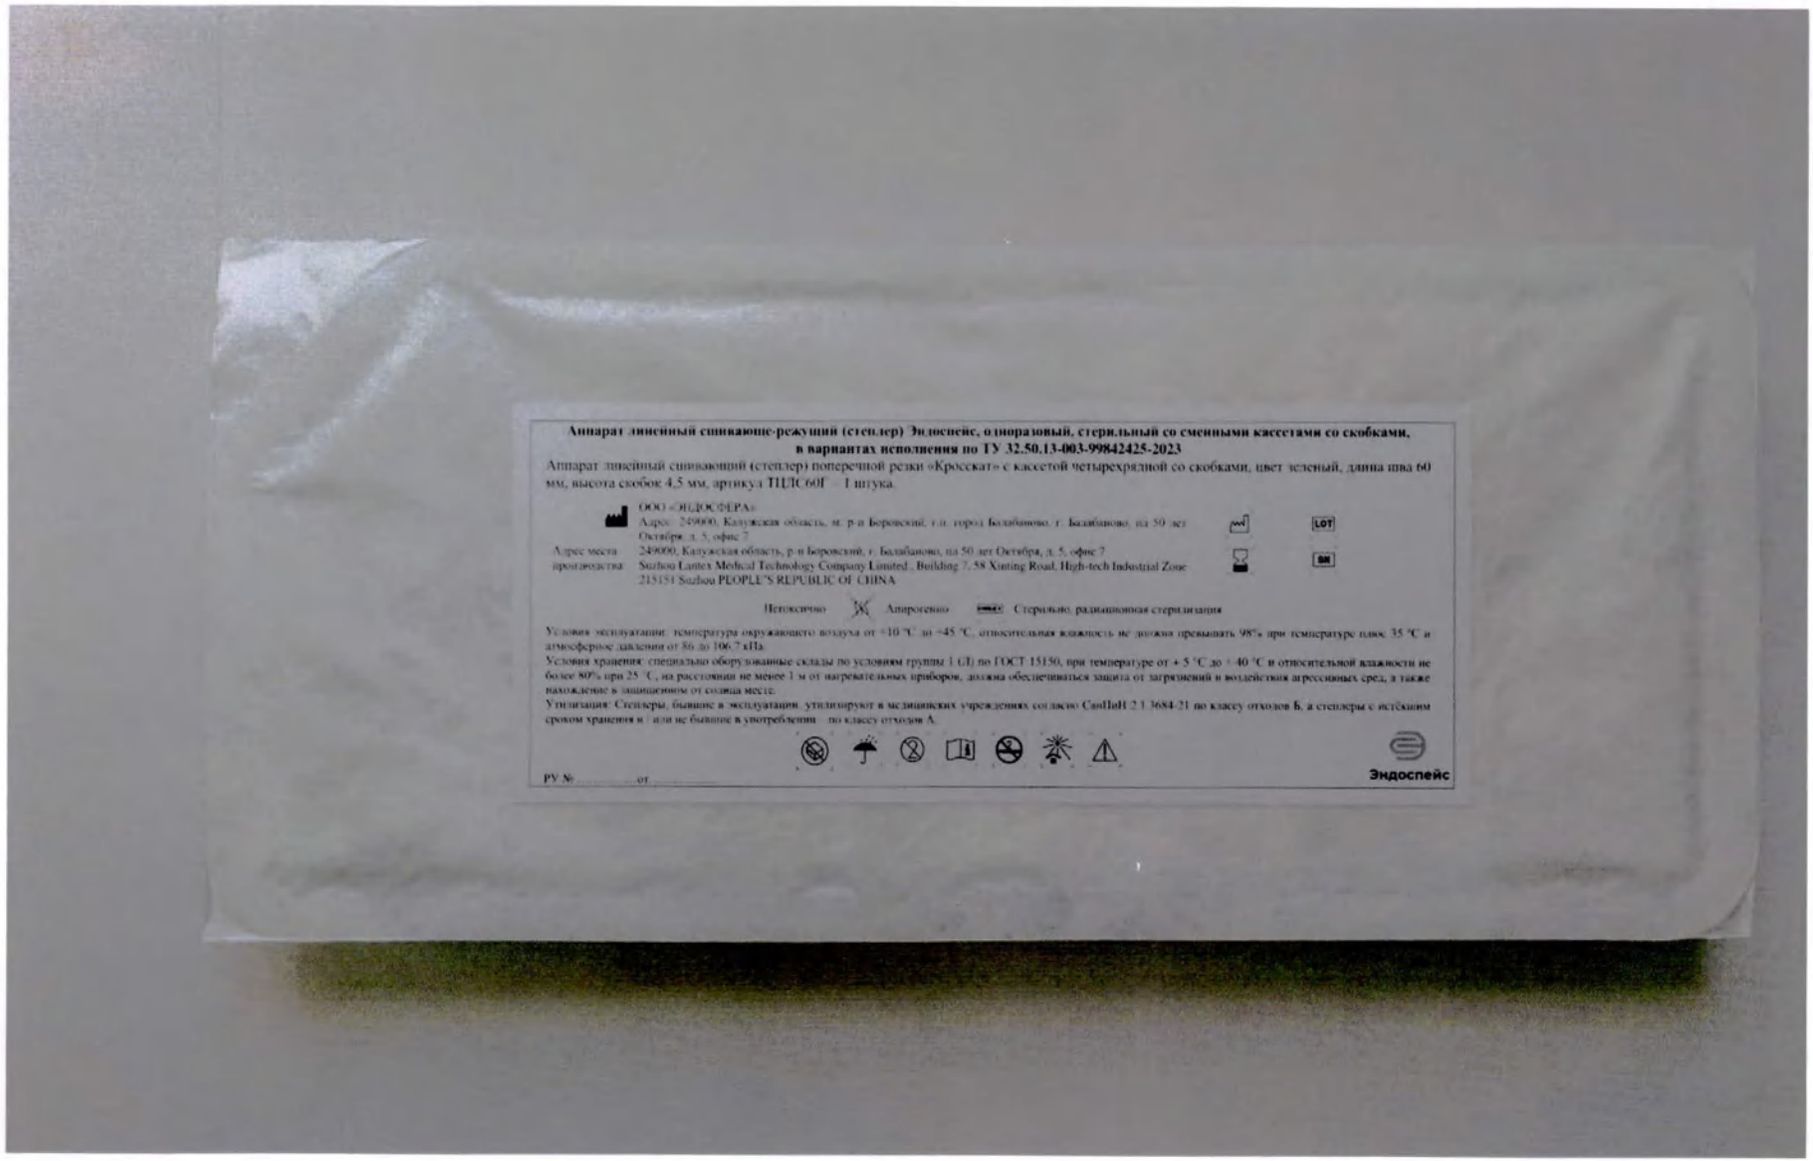

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, ул 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, ул 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №_____ от_____

Эндоспейс

Рисунок 202 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

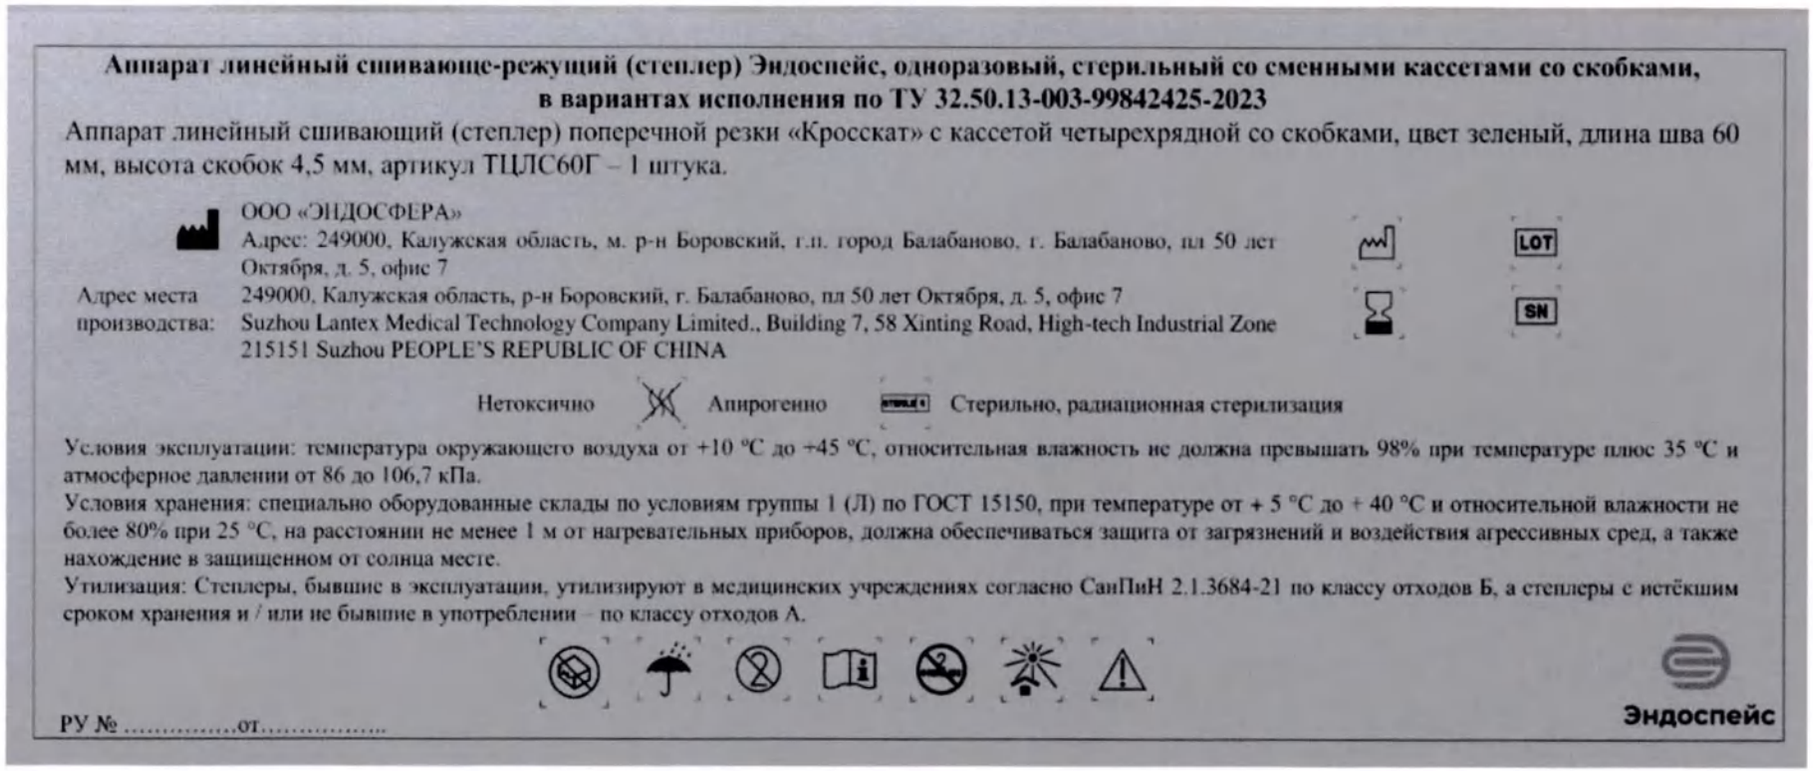

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давлении от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 202А – Маркировка индивидуальной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

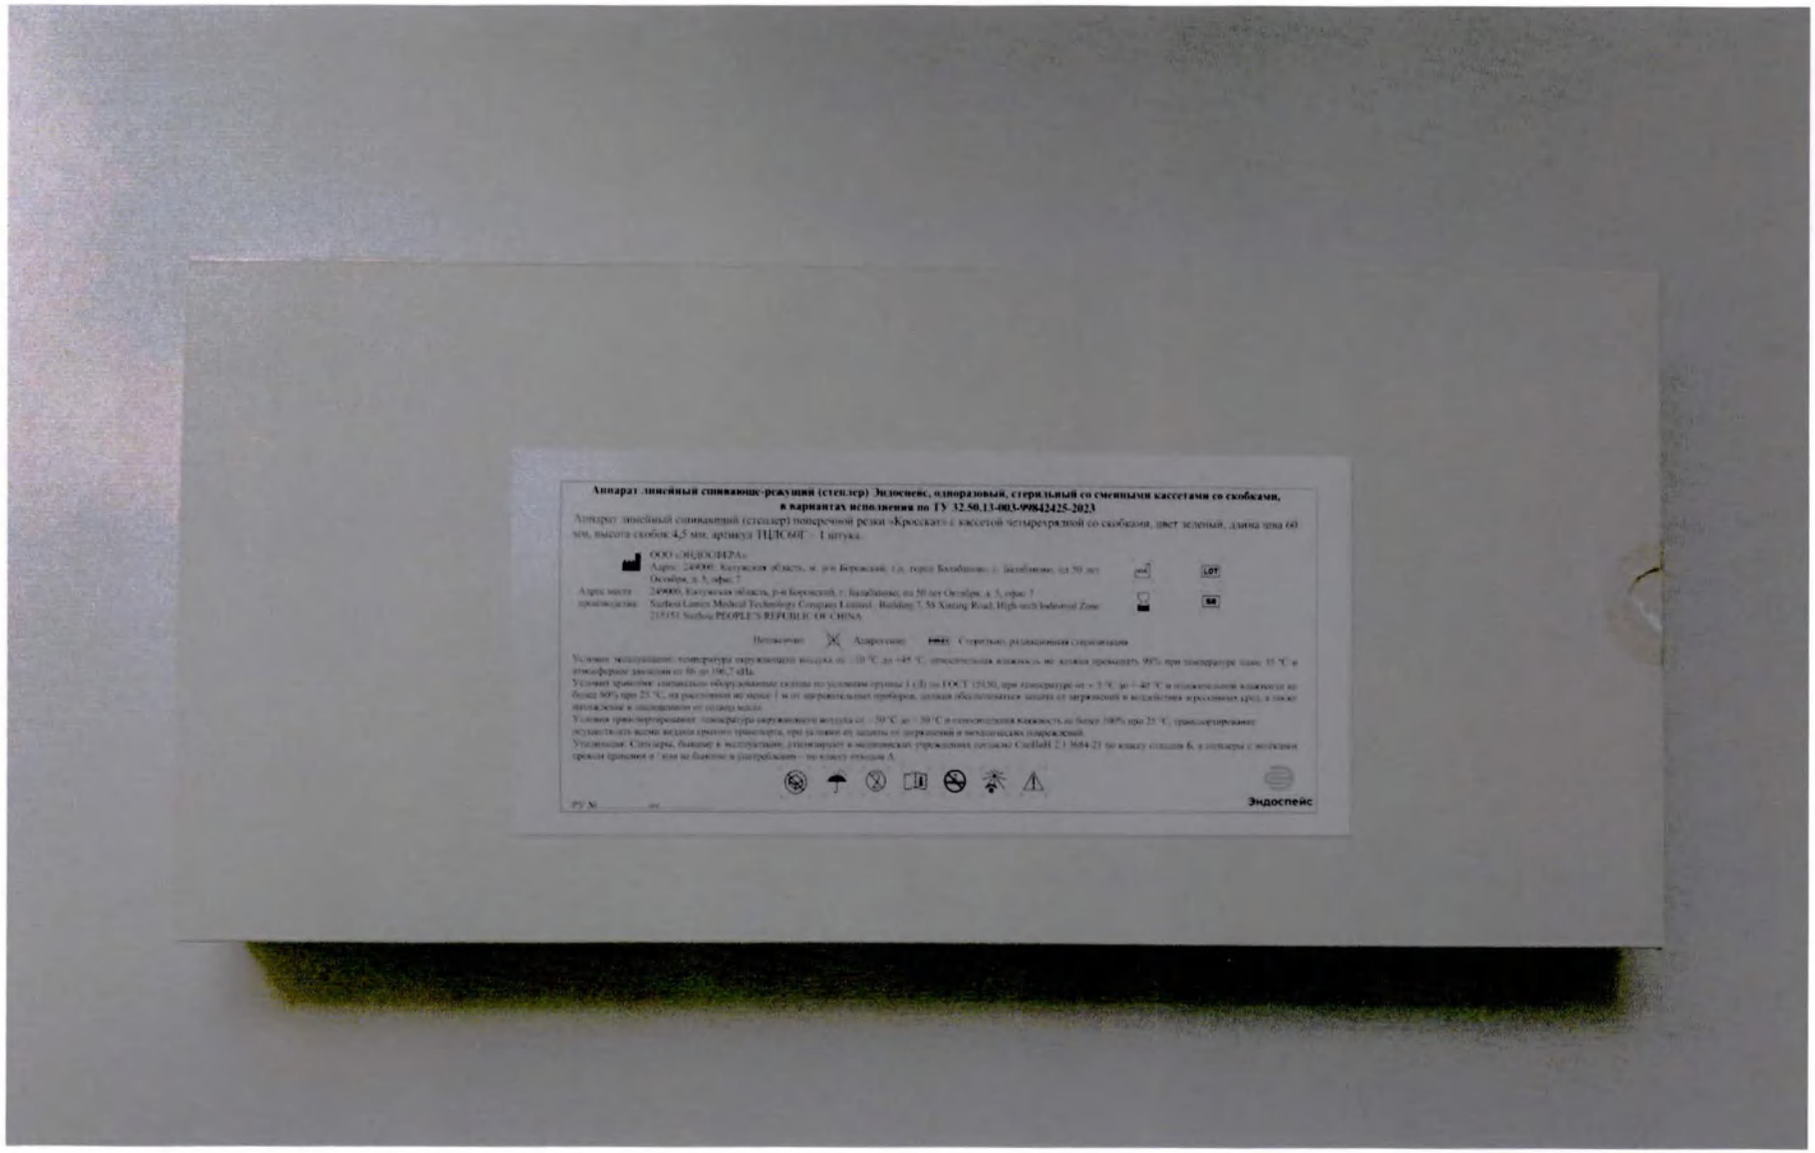

Рисунок 203 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

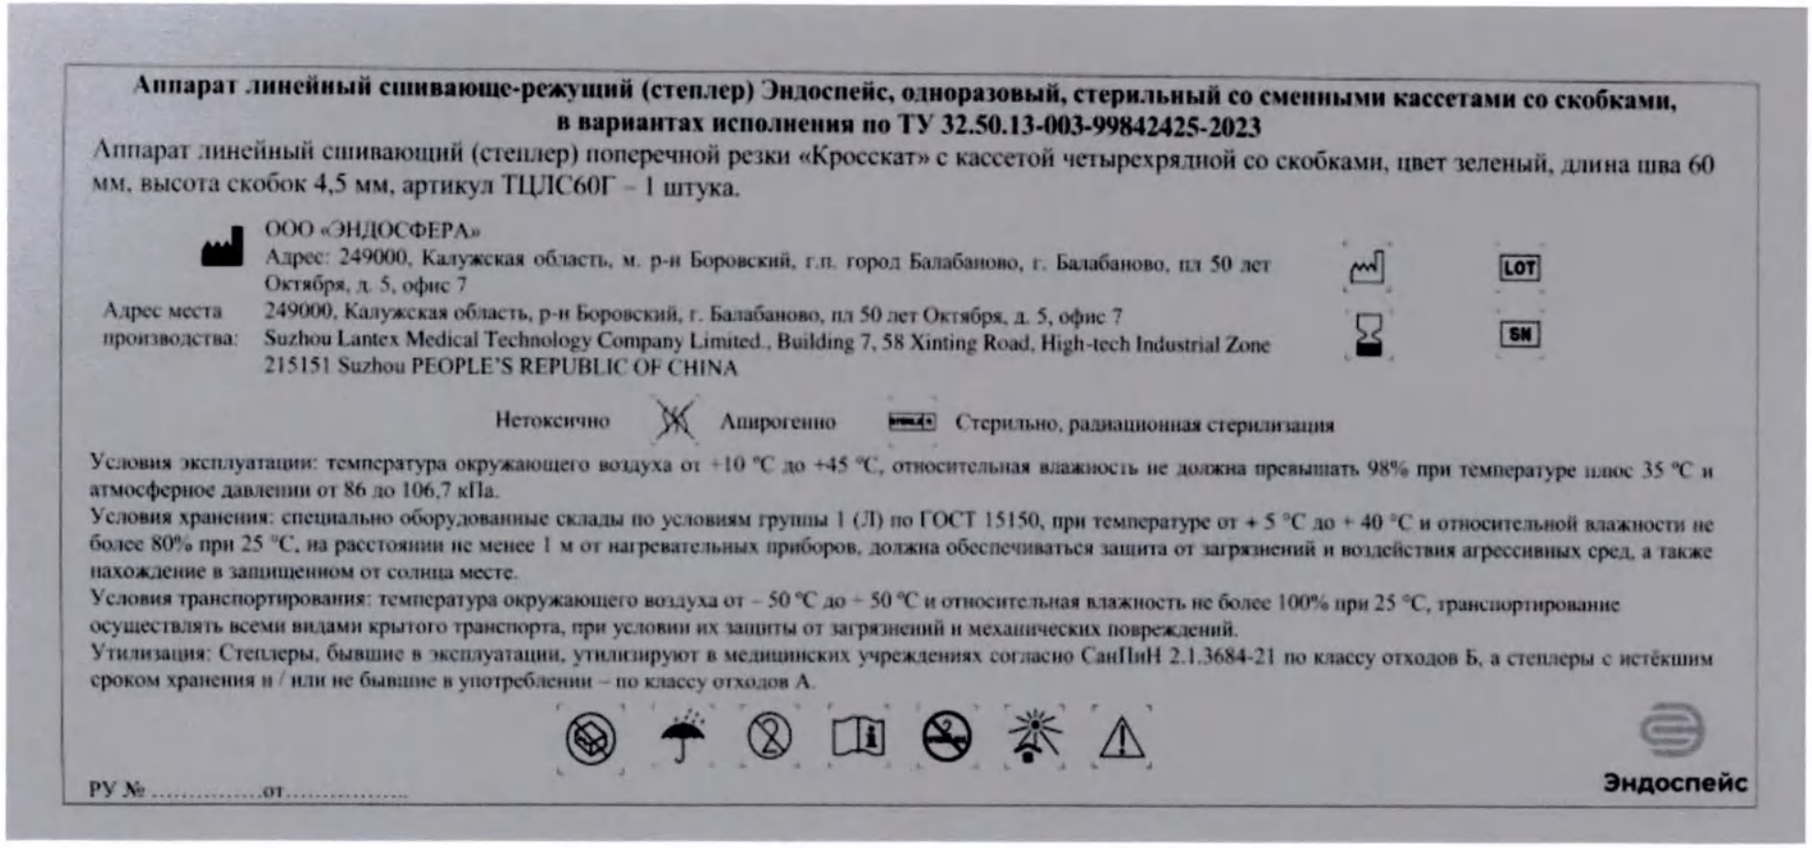

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г – 1 штука.

ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

LOT

SN

Нетоксично Апирогенно Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № .....от.....

Эндоспейс

Рисунок 203А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

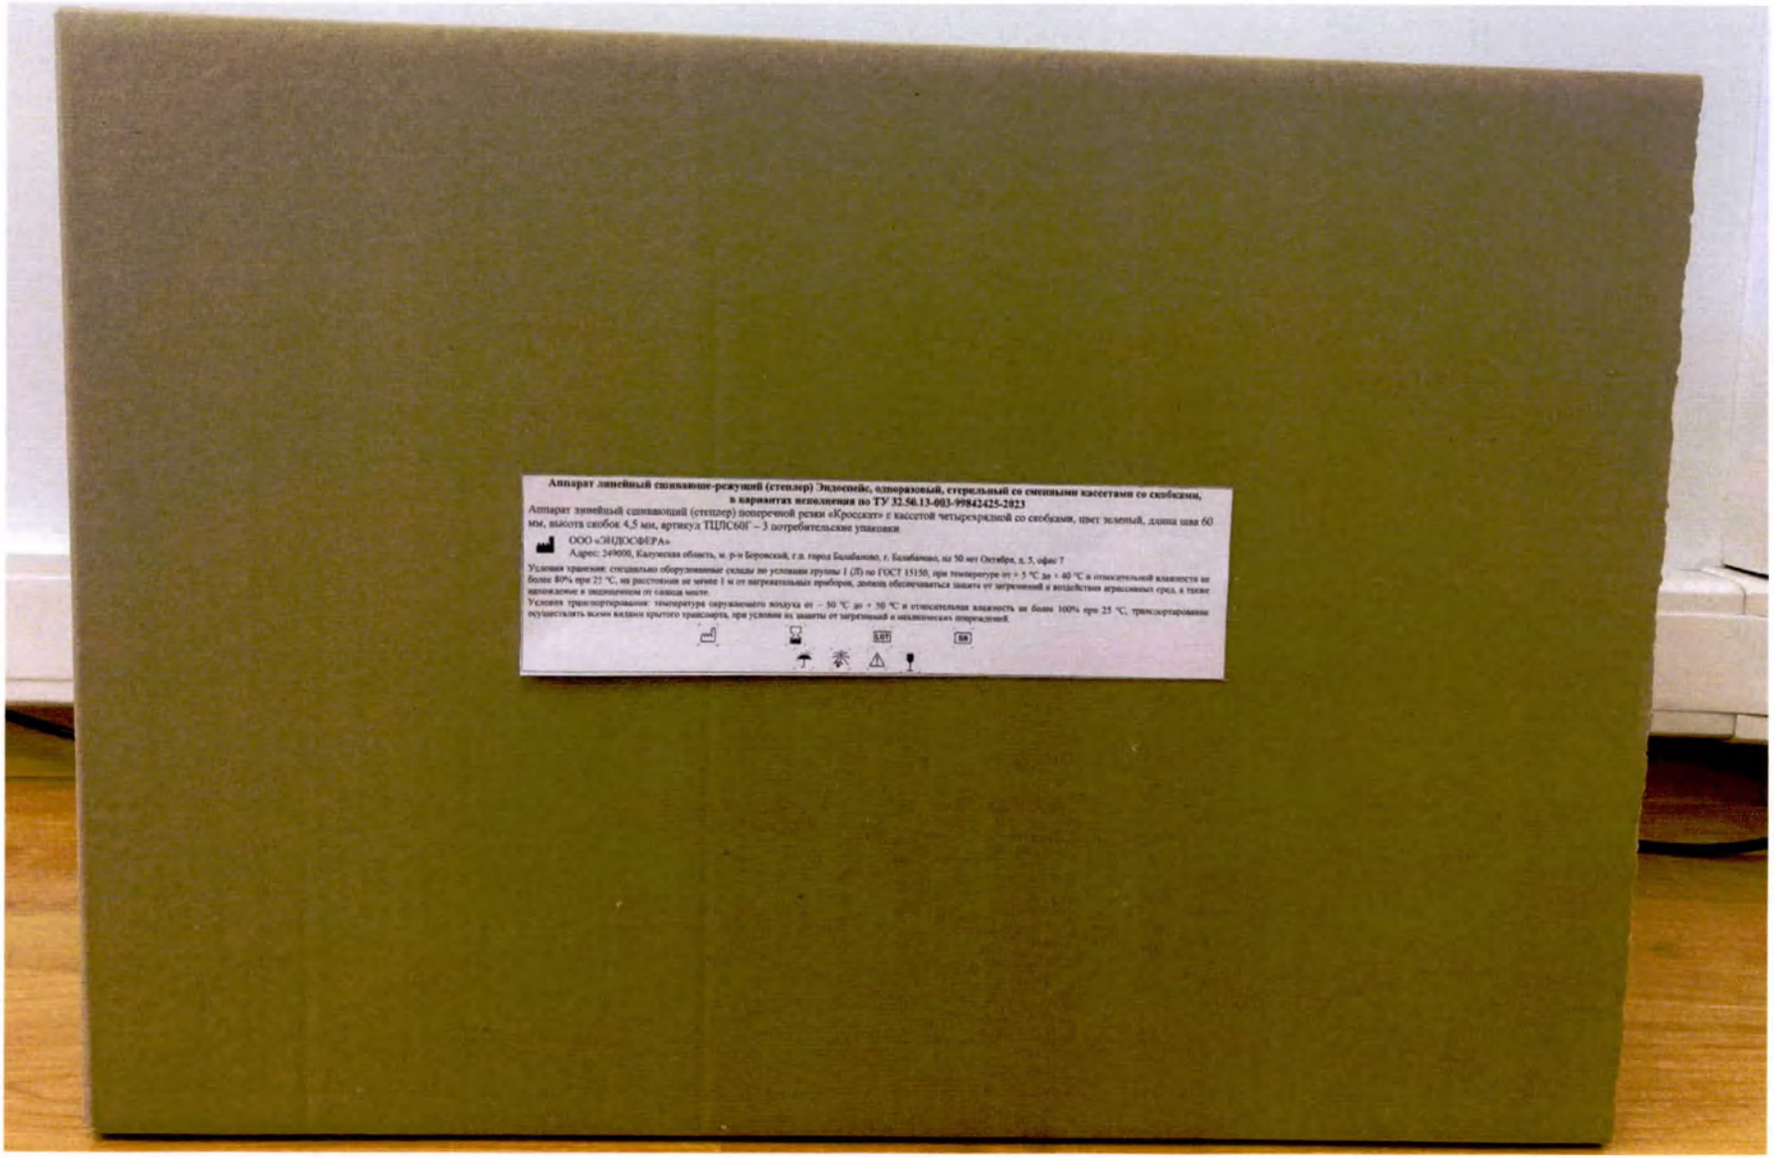

Рисунок 204 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

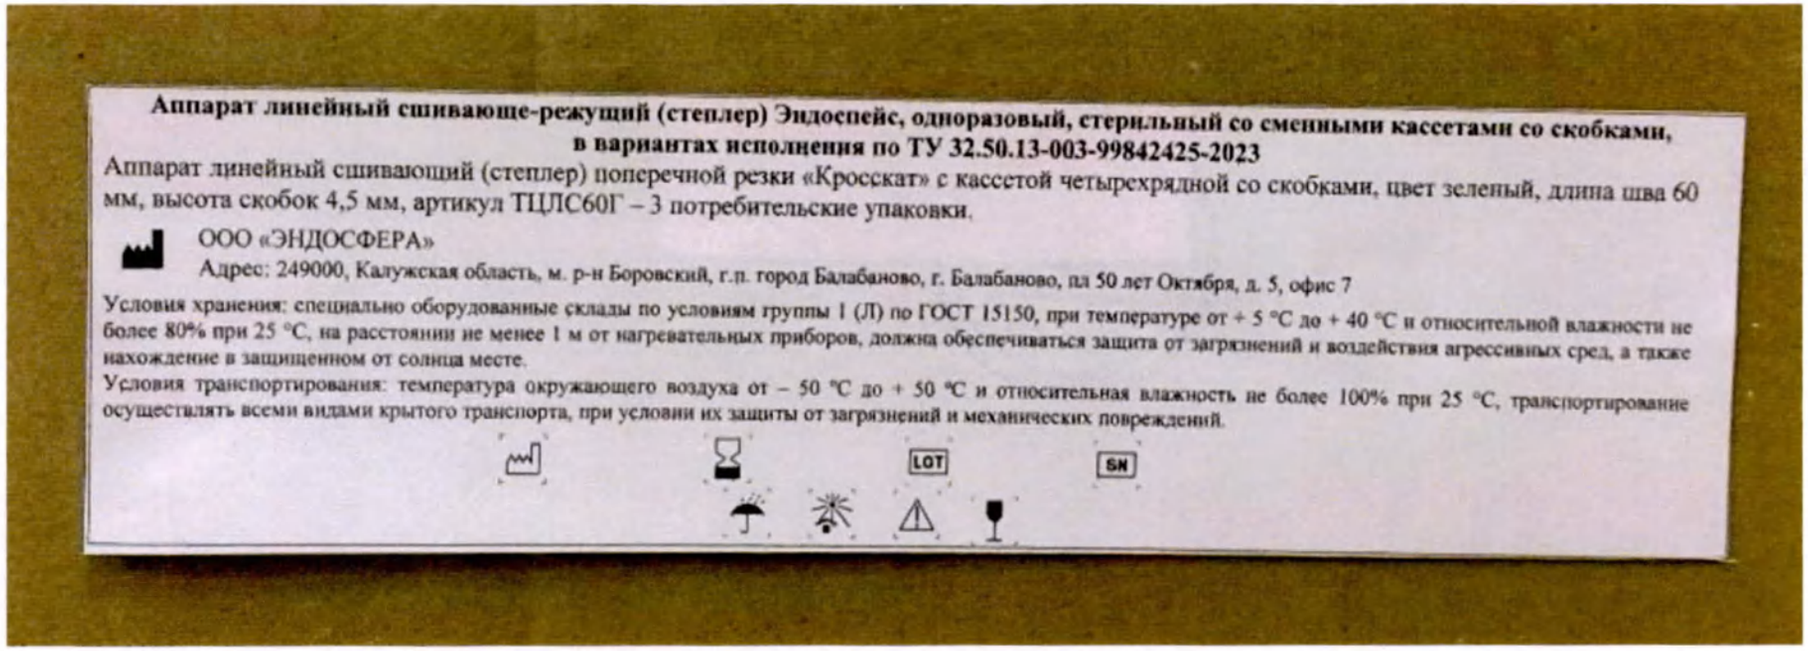

Аппарат линейный сшивающе-режущий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-99842425-2023

Аппарат линейный сшивающий (степлер) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г – 3 потребительские упаковки.

ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

LOT SN

Рисунок 204А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата линейного сшивающего (степлера) поперечной резки «Кросскат» с кассетой четырехрядной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул ТЦЛС60Г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и
скреплено 375 листов
ООО «ЭНДОСФЕРА»
Генеральный директор
_____ / Е.В.Реукова
5 февраля 2024 г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU