

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедТестКонсалтинг»



Бунзя.В.К.

2024 г.
М.П.

Дополнение к Фотографиям медицинского изделия:

«Аппарат лазерной абляции ECHOLASER X4 с принадлежностями»,
производство: «Эл. Эн. С.п.А.», Италия / El. En. S.p.A., Italy



Фото 1. Аппарат лазерной абляции ECHOLASER X4. Маркировка.



El.En. S.p.A.
Via Baldanzese 17 - 50041
Calenzano (Fi) Italy
Tel. +39 0558826807
Fax +39 0558832884

ECHOLASER X4

REF M095A1 **SN** IA6B4301A

220-240V~ 50/60Hz
400VA



2016-10



2xT5A 250V 6.3x32mm

ON/OFF 10min/5min



0459



Made in Italy

079301814 Rev B



Фото 3. Транспортная тара.



Фото 4. Макет маркировки транспортной тары.

Ген. директор
ООО "МедТест Консалтинг"
Буча В.Р.
Взаимодействие при осуществлении
деятельности по 5 (none)



Фотографии медицинского изделия:

«Аппарат лазерной абляции ECHOLASER X4 с принадлежностями»,

производство: «Эл. Эн. С.п.А.», Италия / El. En. S.p.A., Italy

1. Аппарат лазерной абляции ECHOLASER X4 на тележке транспортировочной.
Блок основной аппарата ECHOLASER X4.
2. Аппарат лазерной абляции ECHOLASER X4. Маркировка.
3. Аппарат лазерной абляции ECHOLASER X4. Маркировка.
4. Аппарат лазерной абляции ECHOLASER X4. Маркировка.
5. Переключатель ножной.
6. Ключ для блокировки аппарата.
7. Кабель сетевого питания.
8. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика LA332:
держатель
9. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика LA332:
опора направляющая, угол 65°.
10. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика LA332:
опора направляющая, угол 70°.
11. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика LA332:
опора направляющая, угол 75°.
12. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика LA332:
блок направляющий.
13. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика
CA430/CA431: держатель.
14. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика
CA430/CA431: опора для направляющего блока.
15. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика
CA430/CA431: блок направляющий, угол 15°.
16. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика
CA430/CA431: блок направляющий, угол 30°.

17. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика СА541:
держатель.
18. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика СА541:
опора для направляющего блока, угол 28.
19. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика СА541:
опора для направляющего блока, угол 38°.
20. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика СА541:
блок направляющий.
22. Устройство блокировочное.
23. Предохранитель 5АТ 250V 6.3х32 мм.
24. Табличка предупреждающая.
25. Ключ торцевой, размер 3 мм.
26. Винт ТССЕ М4х35 INOX.
27. Винт ТССЕ М4х40 INOX.

Генеральный директор
ООО «МедТестКонсалтинг»

В. К. Буизя

"25^й декабря 2023 г.



(Подпись)

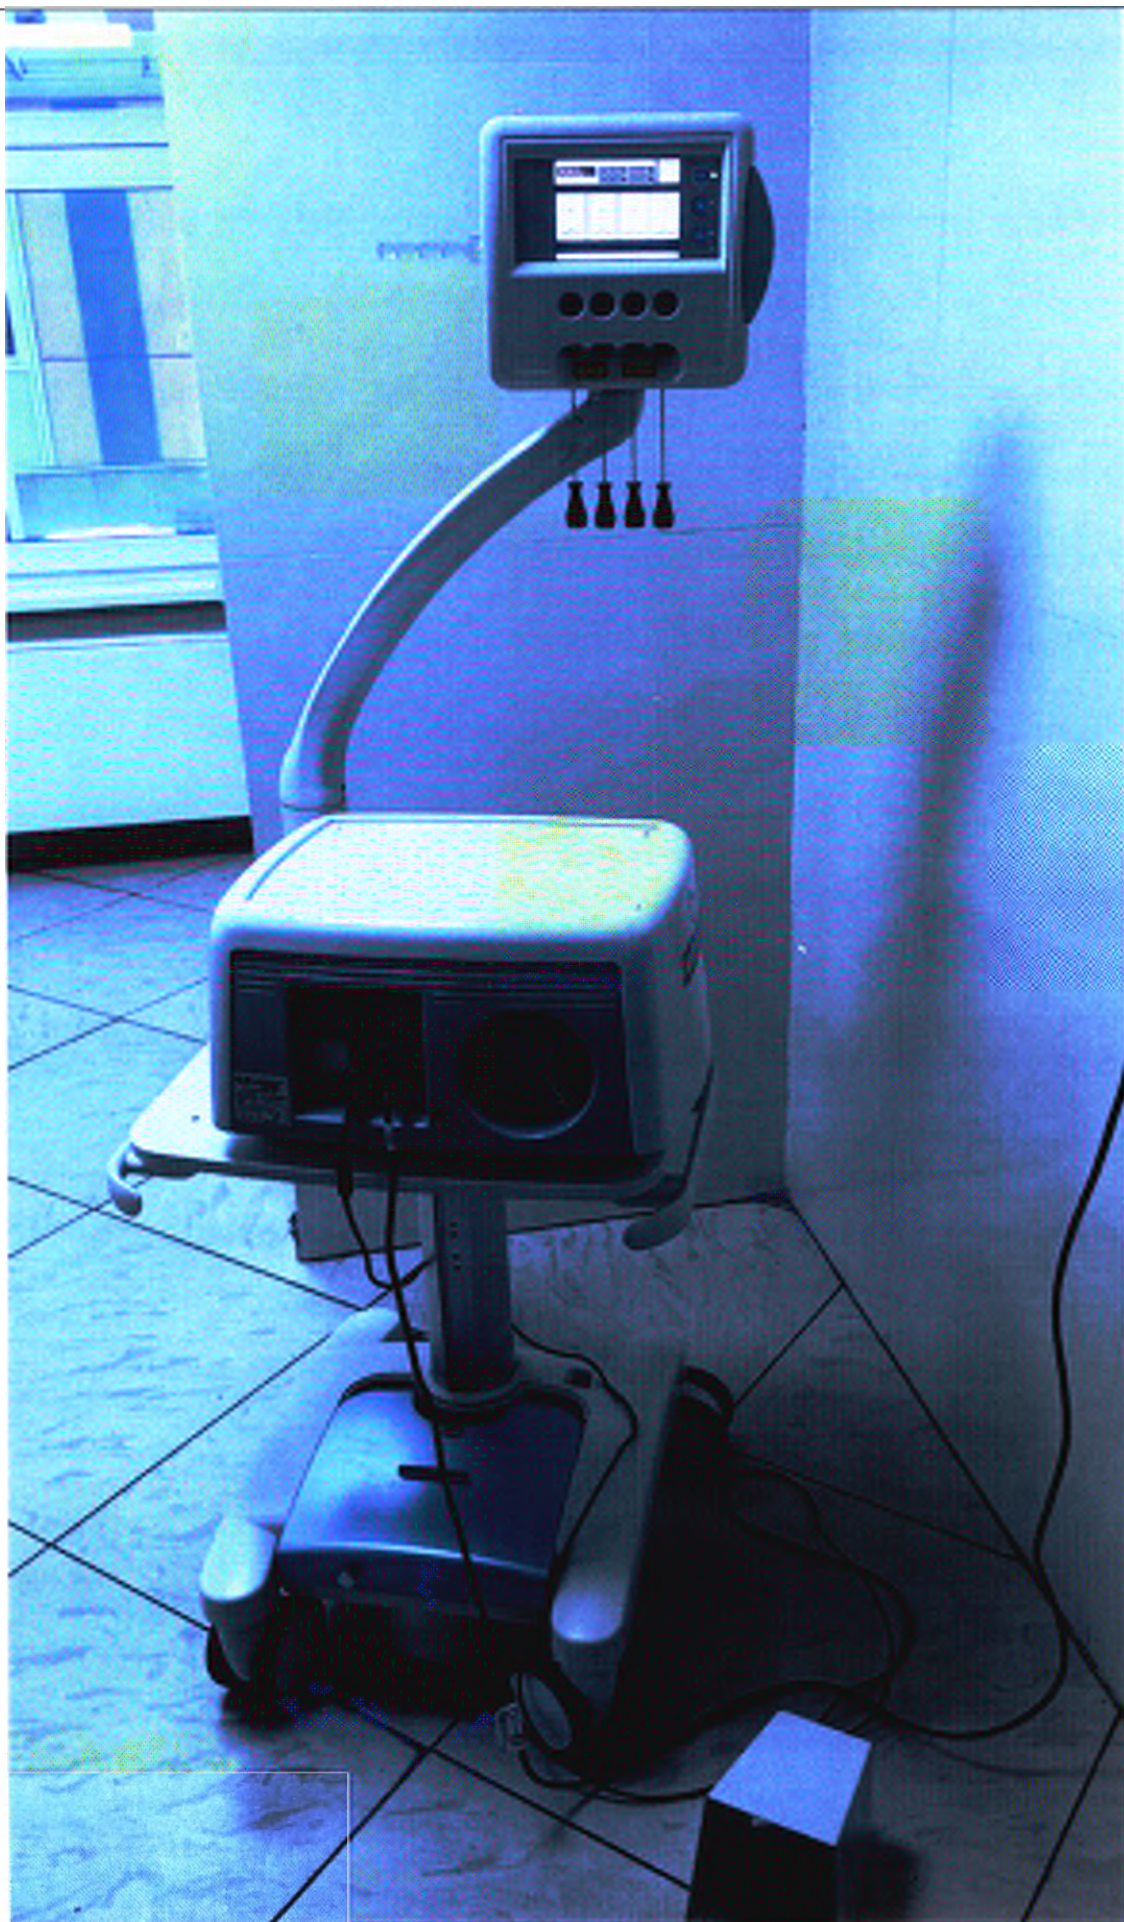


Фото 1. Аппарат лазерной абляции ECHOLASER X4 на тележке транспортировочной. Блок основной аппарата ECHOLASER X4.



Фото. 2 Аппарат лазерной абляции ECHOLASER X4. Маркировка.

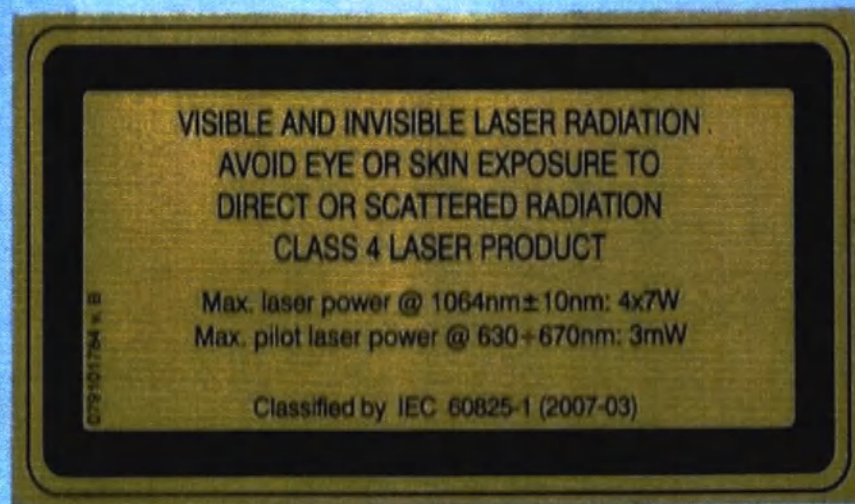


Фото 3. Аппарат лазерной абляции ECHOLASER X4. Маркировка.

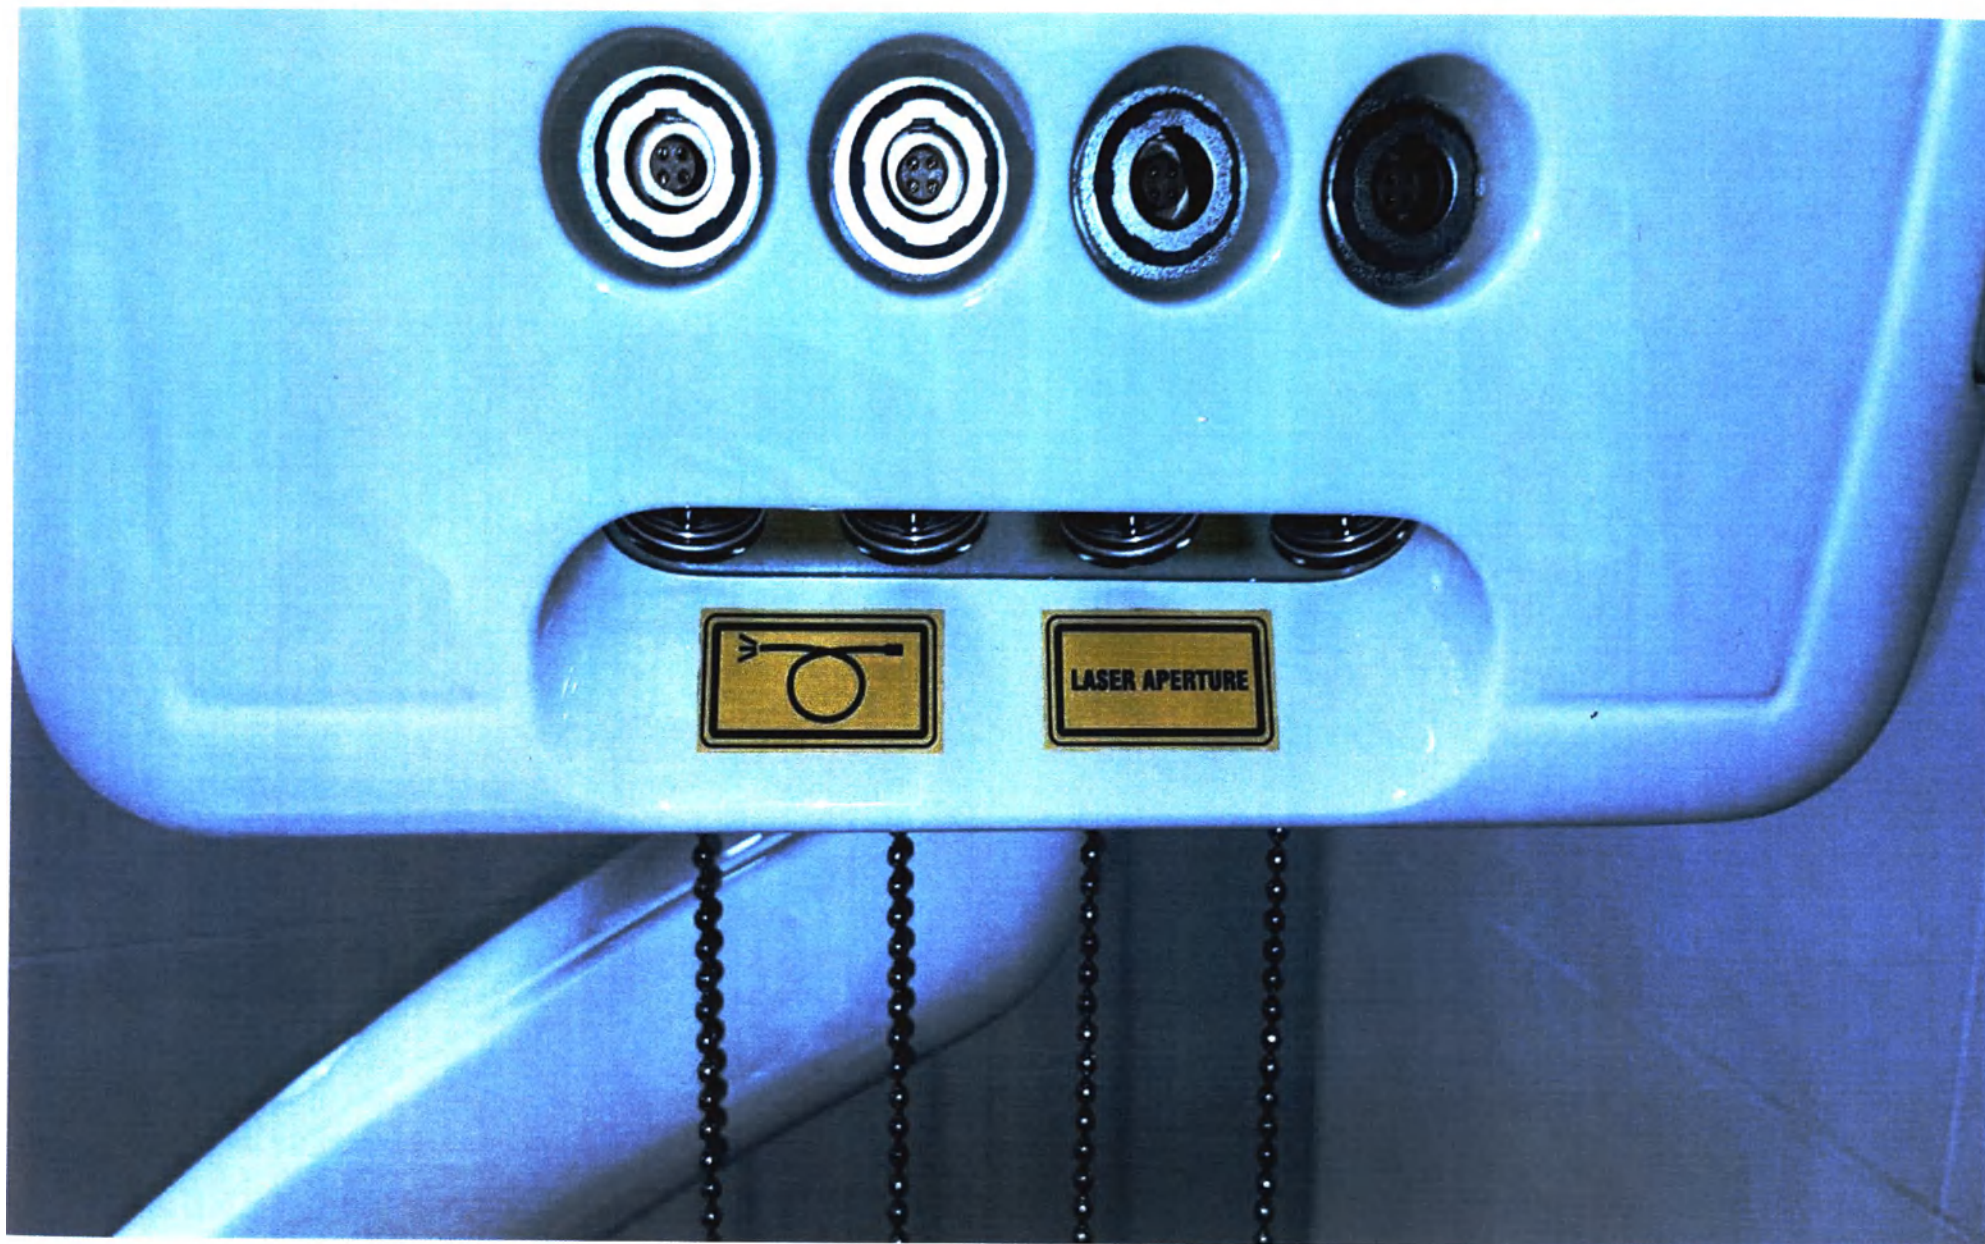


Фото 4. Аппарат лазерной абляции ECHOLASER X4. Маркировка.

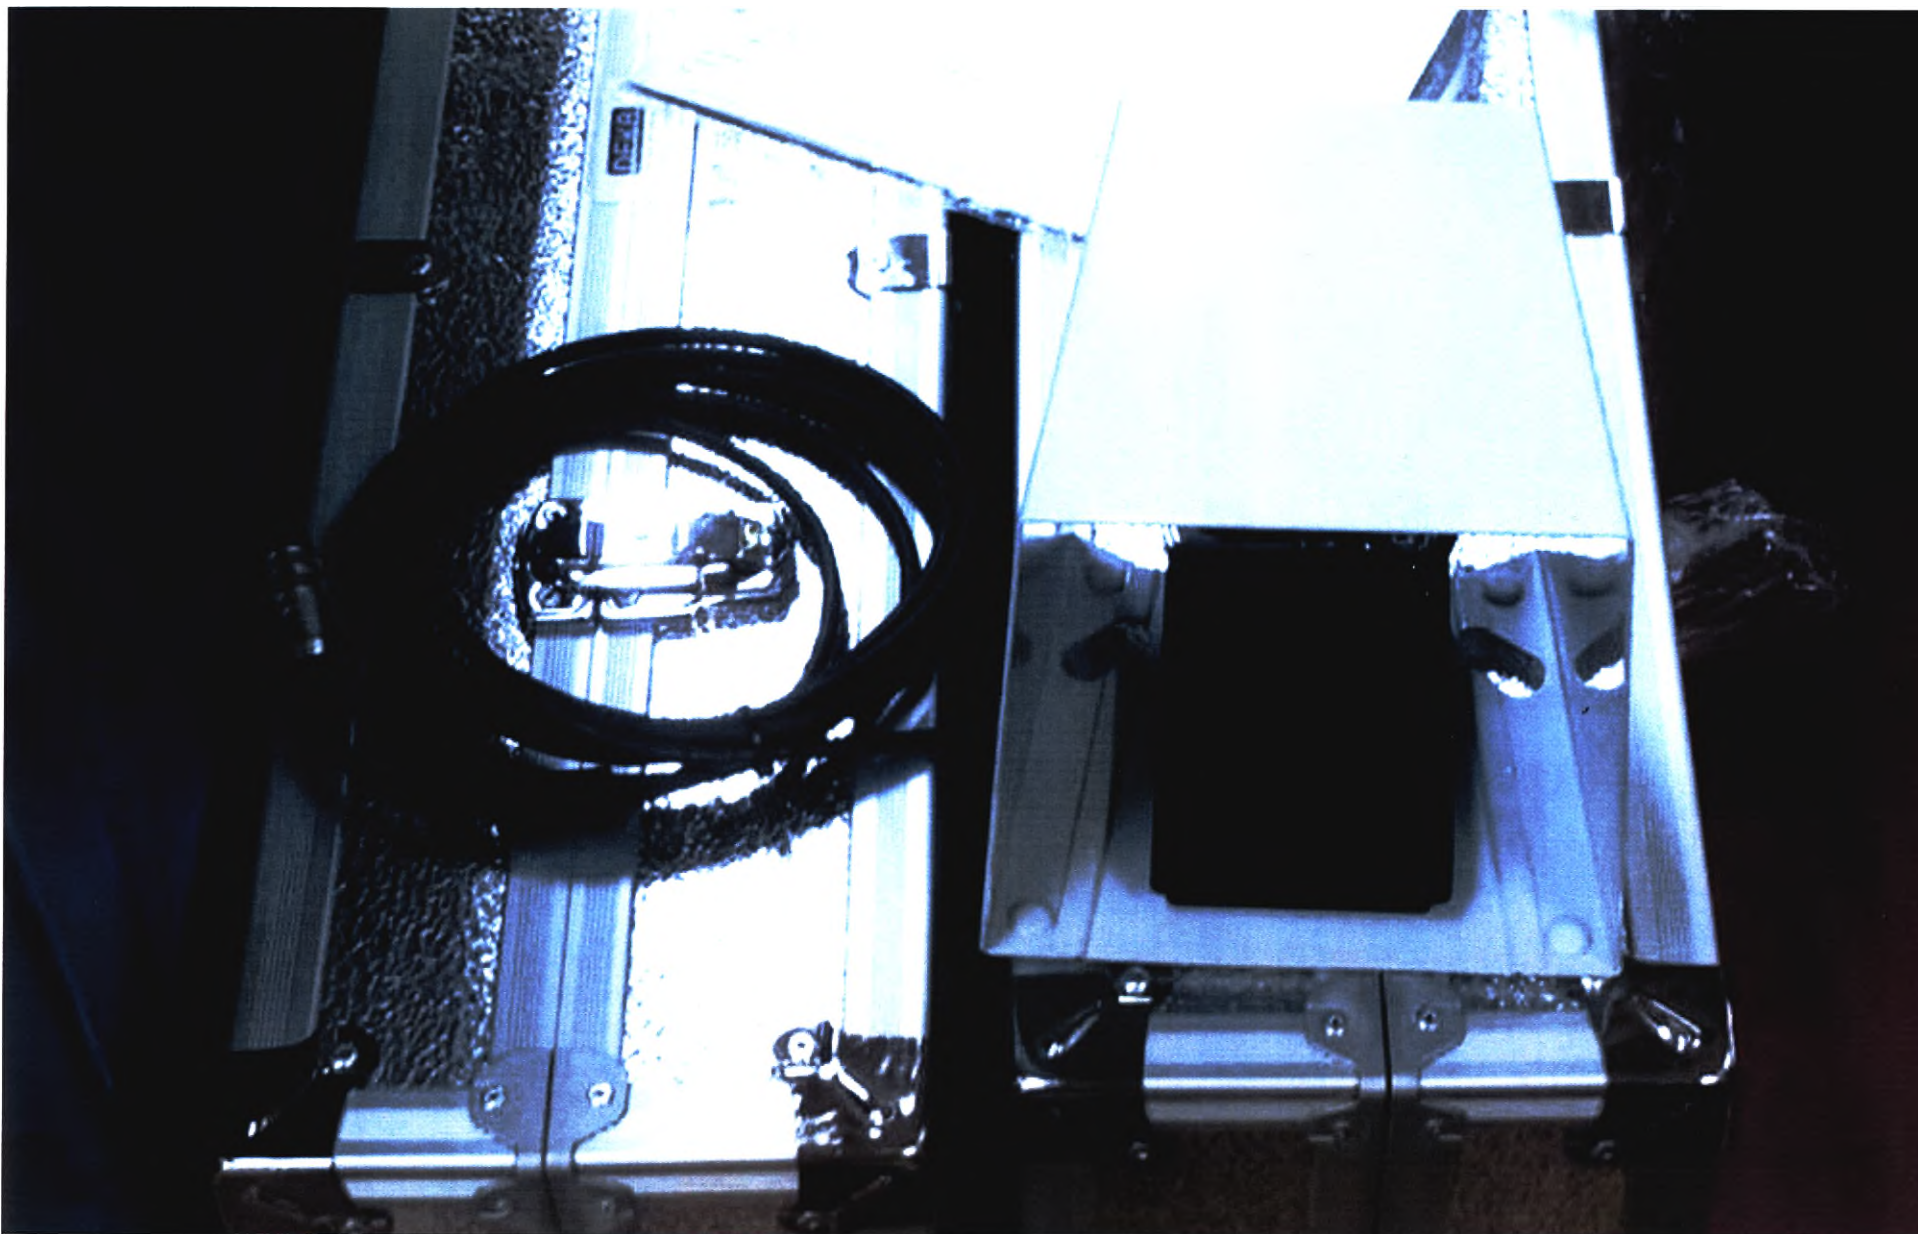


Фото 5. Переключатель ножной.



Фото 6. Ключ для блокировки аппарата.



Фото 7. Аварийный переключатель.



Фото 8. Кабель сетевого питания.



Фото 9. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика LA332: держатель.



Фото 10. Набор опор направляющих многоугольных для ультразвукового датчика LA332: опора направляющая, угол 65° .



Фото 11. Набор опор направляющих многоугольных для ультразвукового датчика LA332: опора направляющая, угол 70° .

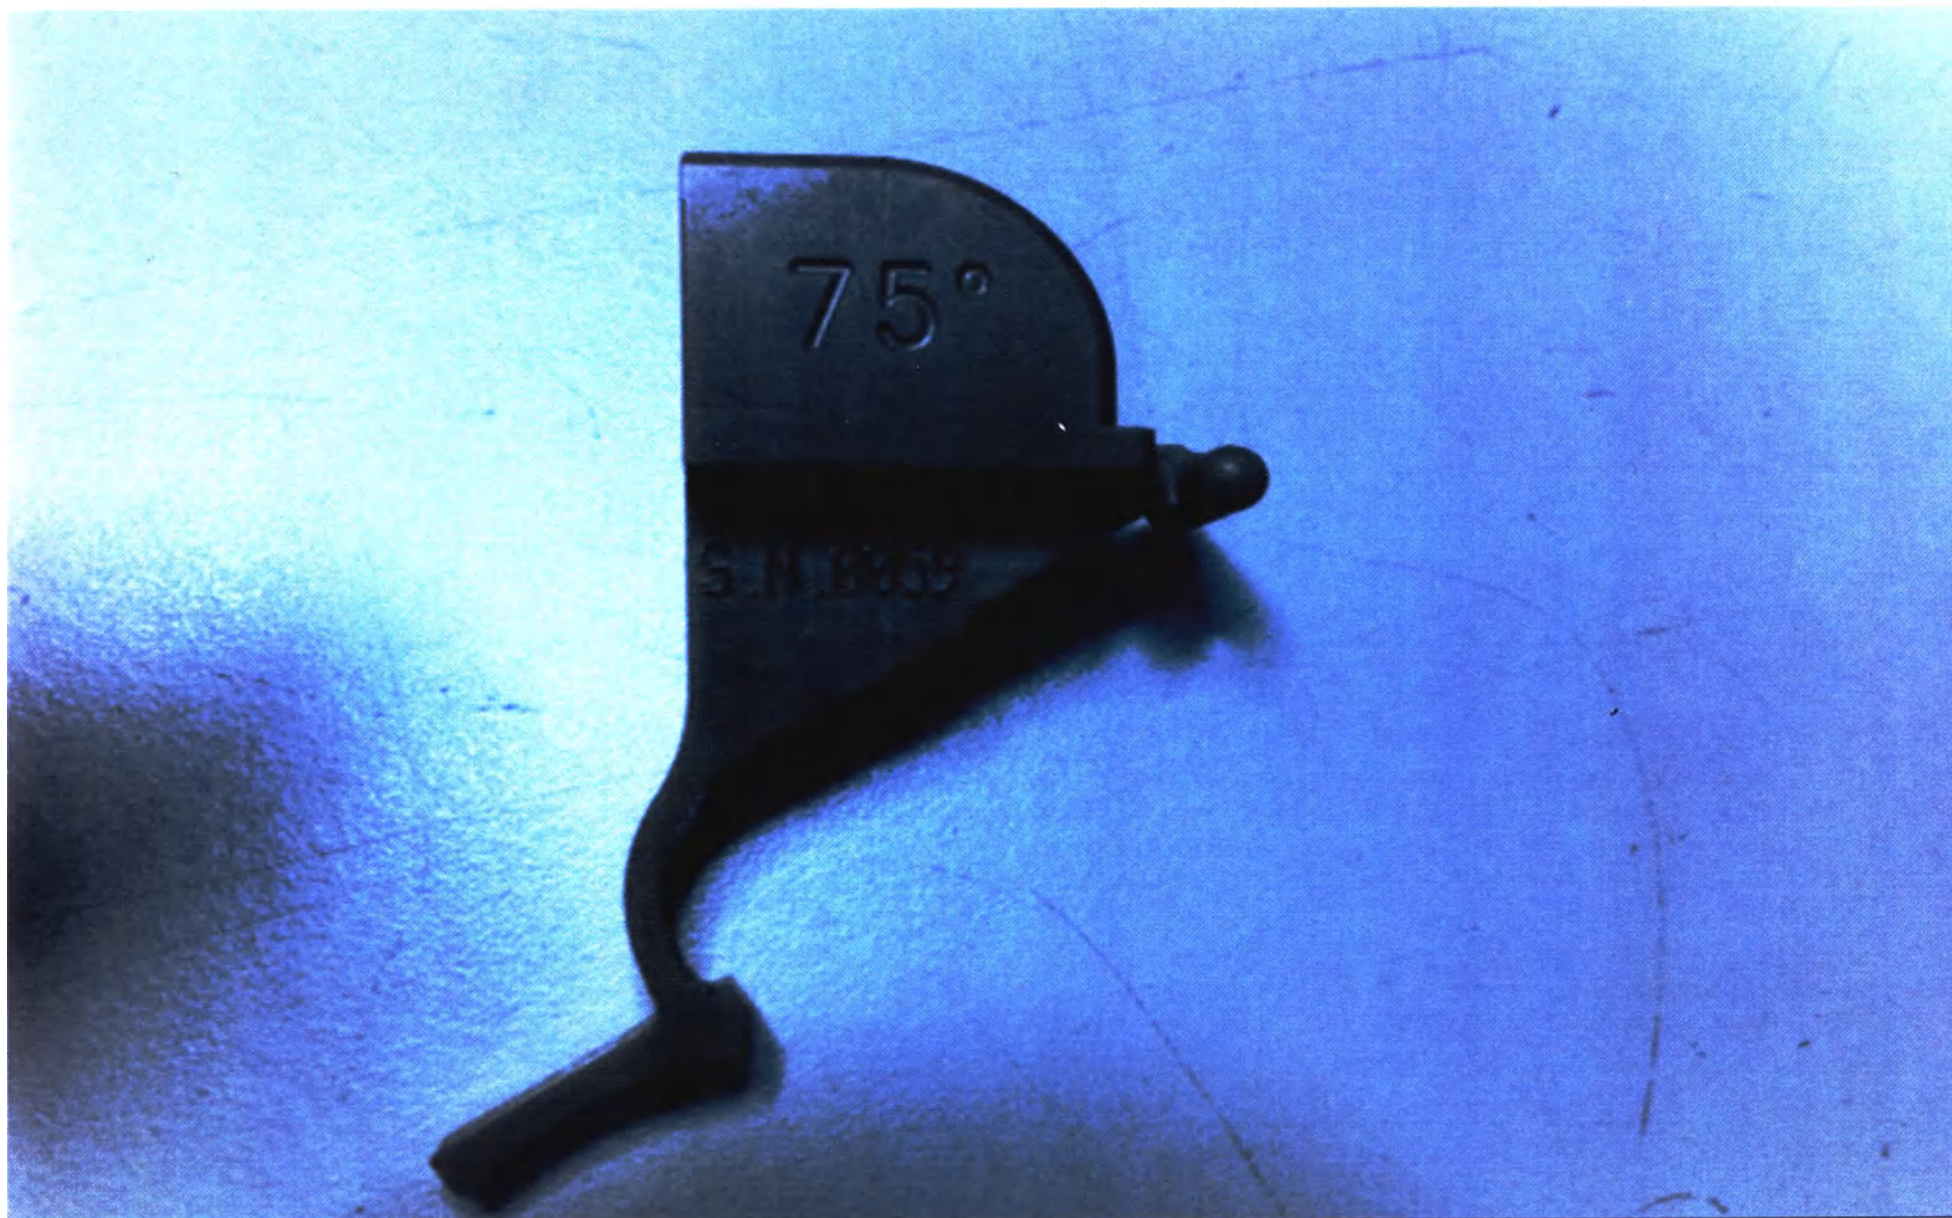


Фото 12. Набор опор направляющих многоугольных для ультразвукового датчика LA332: опора направляющая, угол 75°.



Фото 13. Набор опор направляющих многообразовых для ультразвукового датчика LA332: блок направляющий.

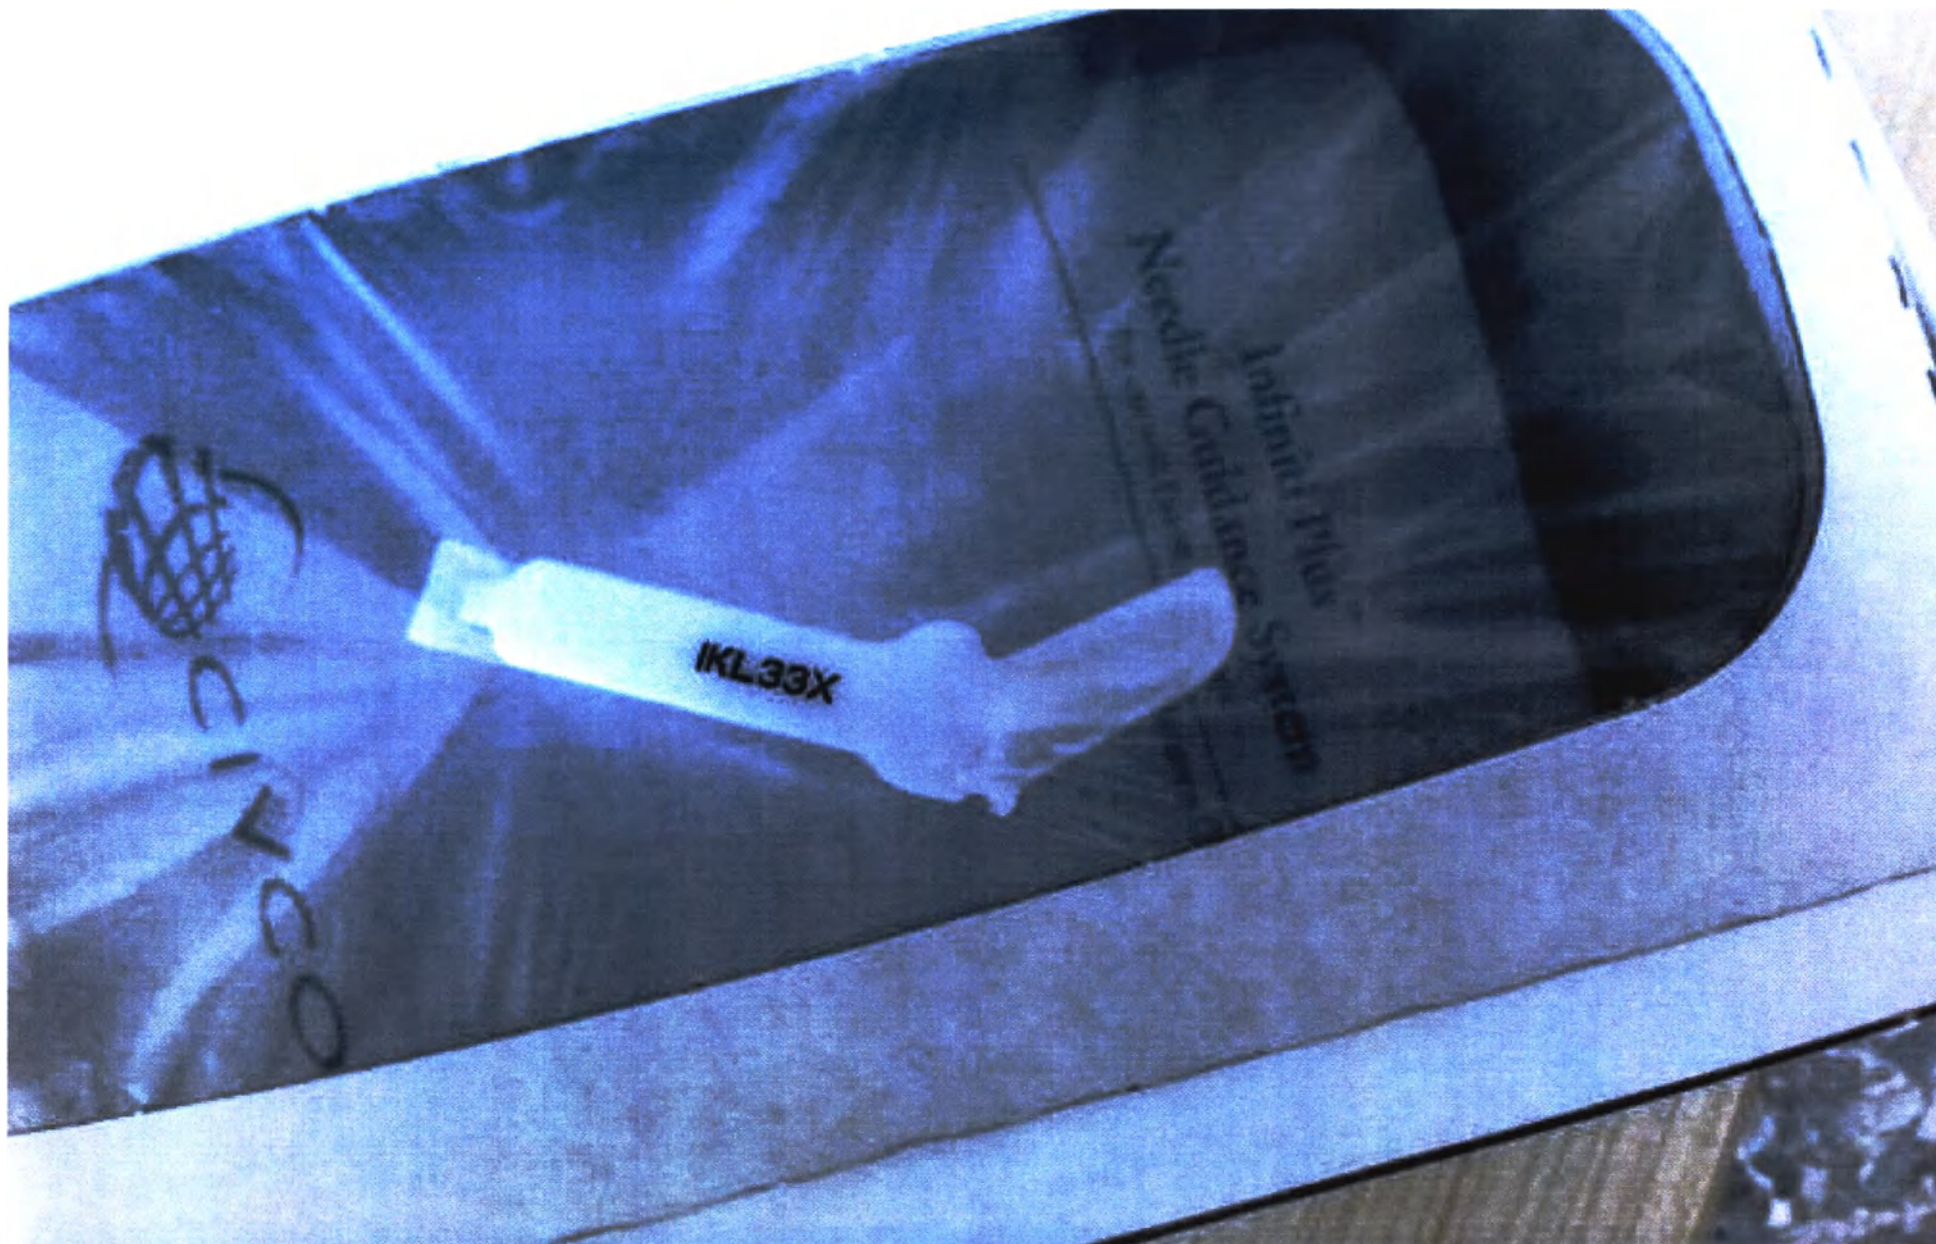


Фото 14. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика СА430/СА431: держатель.

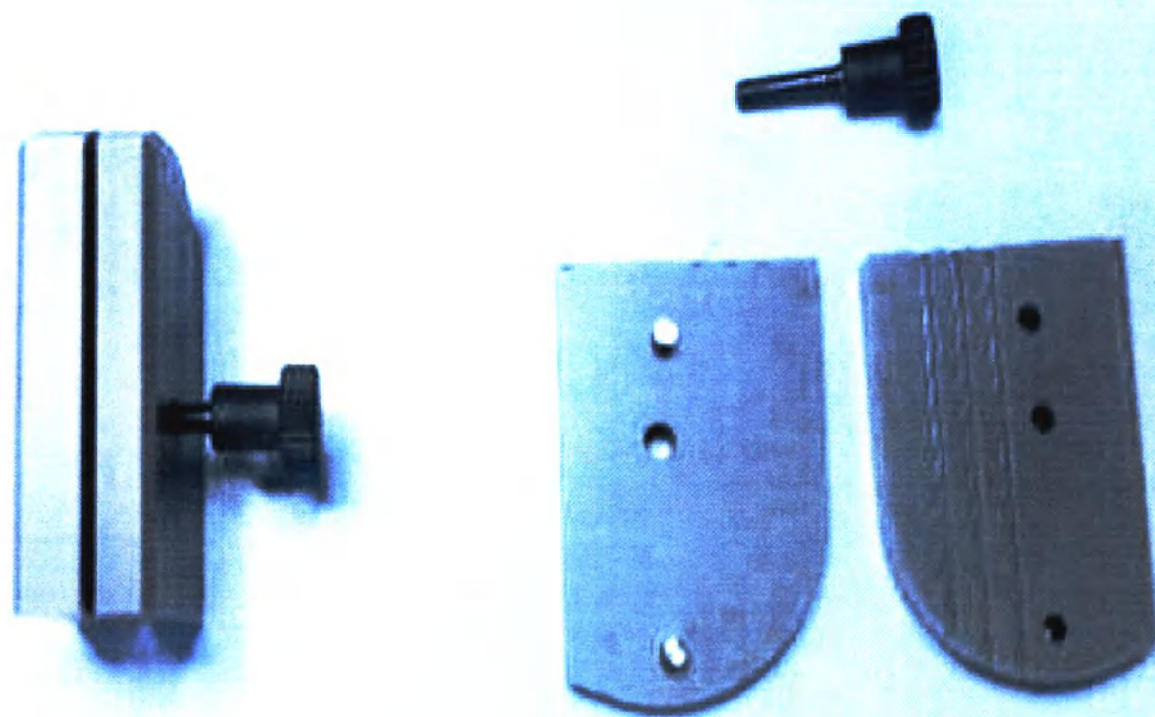


Фото 15. Набор опор направляющих многообразовых для ультразвукового датчика СА430/СА431: опора для направляющего блока.

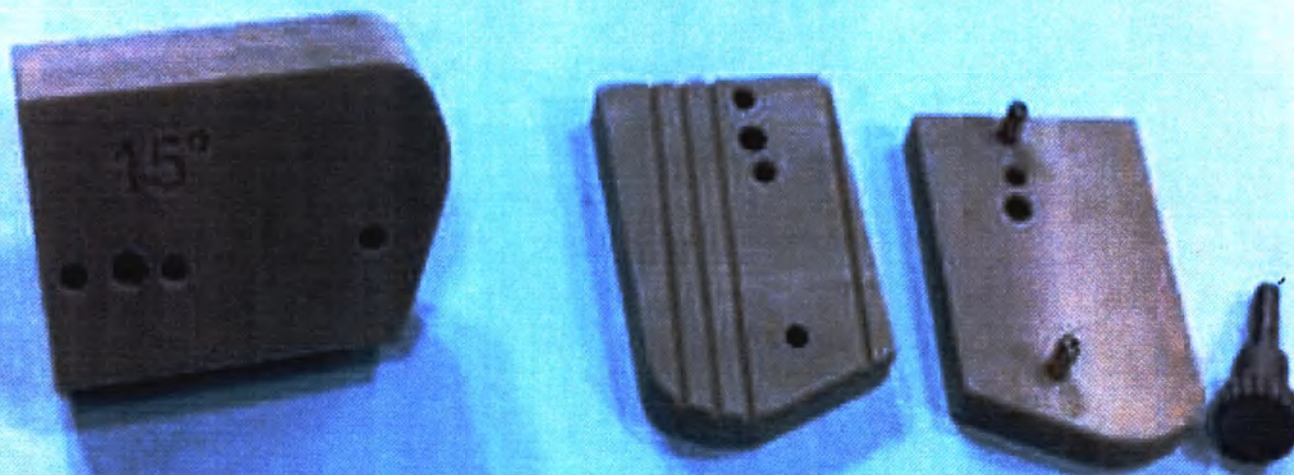


Фото 16. Набор опор направляющих многоугольных для ультразвукового датчика СА430/СА431: блок направляющий, угол 15°.



Фото 17. Набор опор направляющих многоугольных для ультразвукового датчика СА430/СА431: блок направляющий, угол 30°.

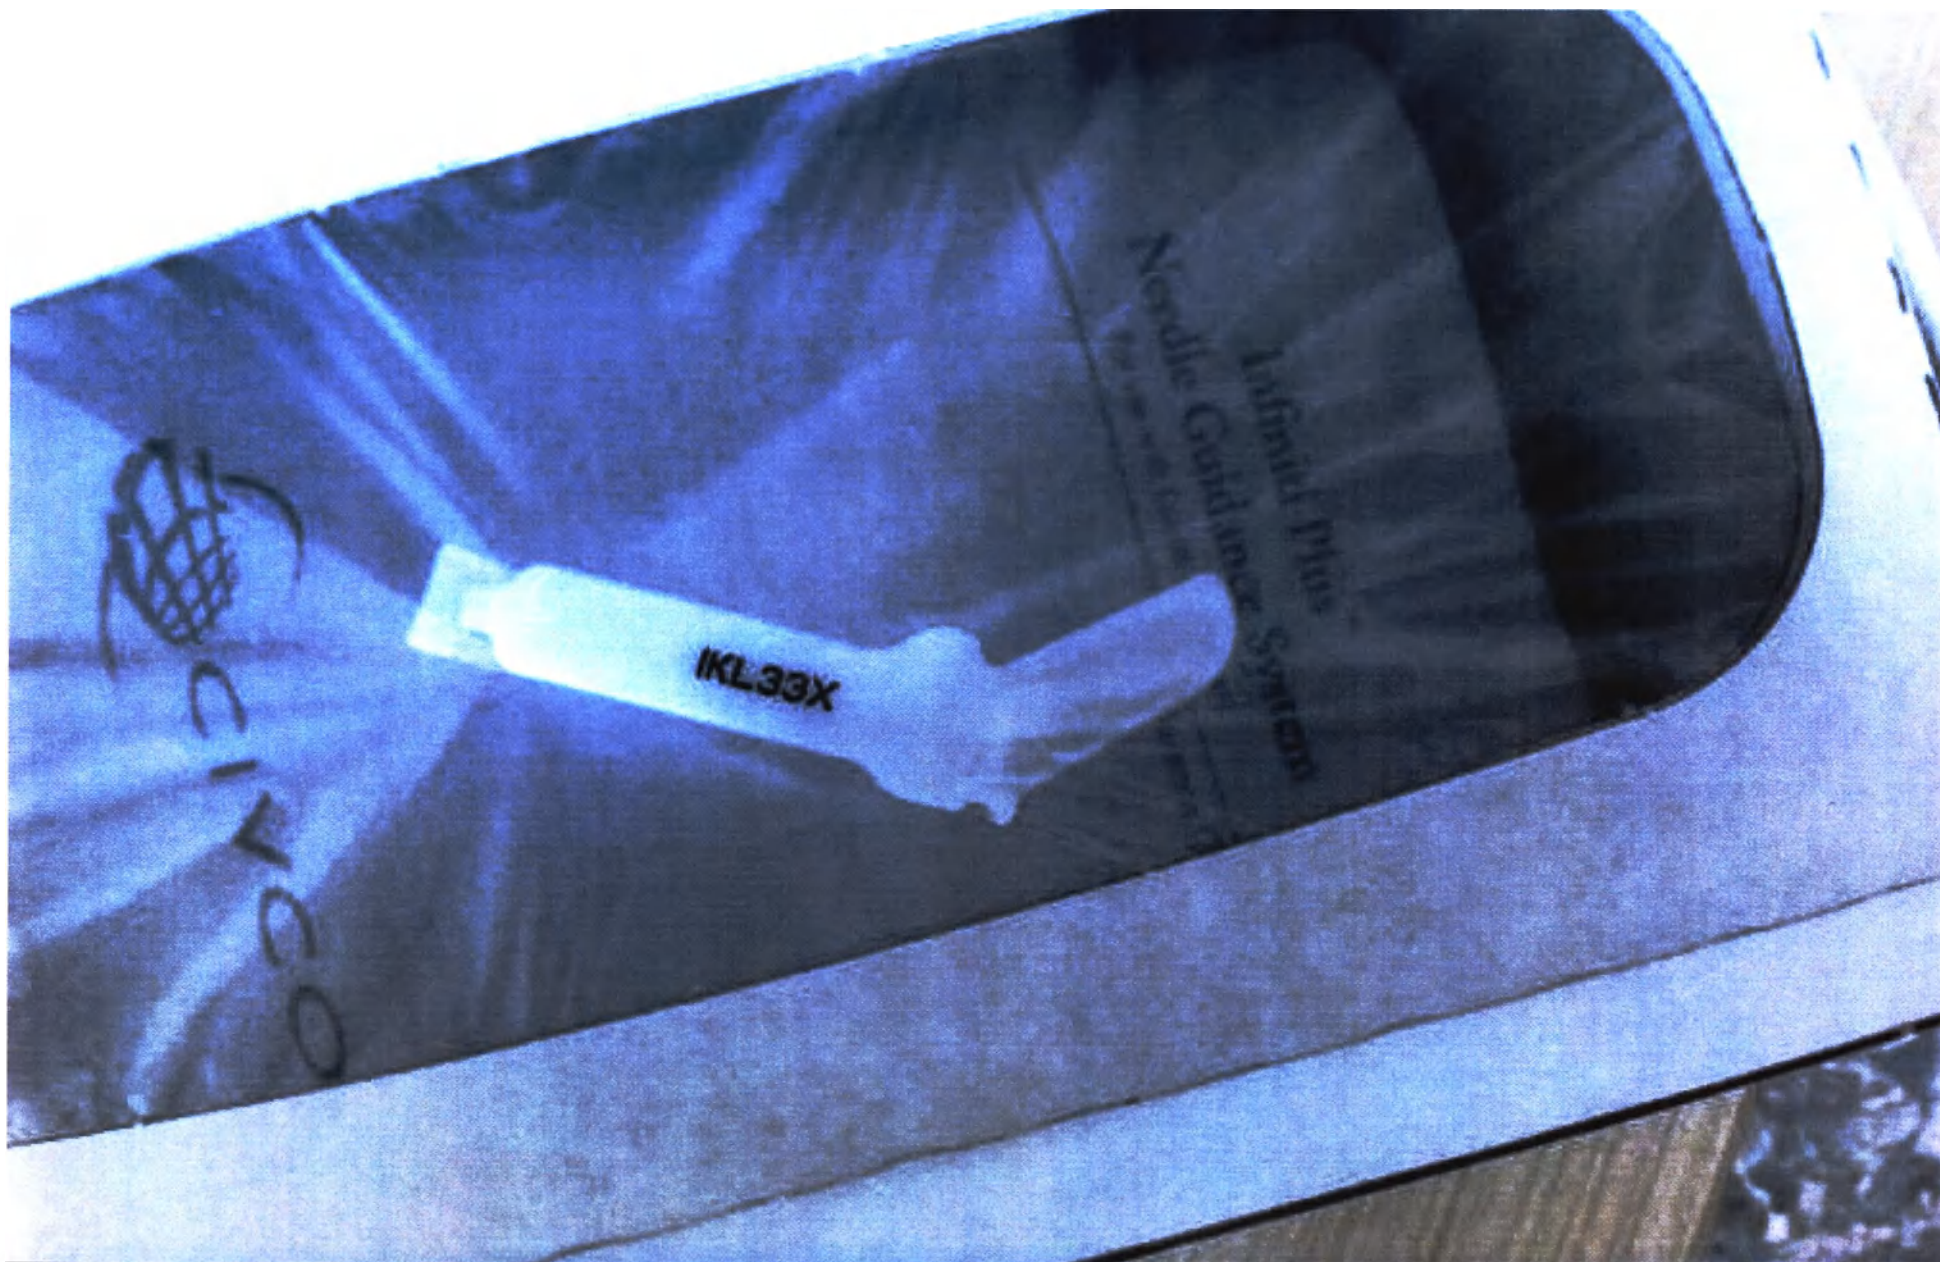


Фото 18. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика СА541: держатель.



Фото 19. Набор опор направляющих многоугольных для ультразвукового датчика СА541: опора для направляющего блока, угол 28° .



Фото 20. Набор опор направляющих многоугольных для ультразвукового датчика СА541: опора для направляющего блока, угол 38° .

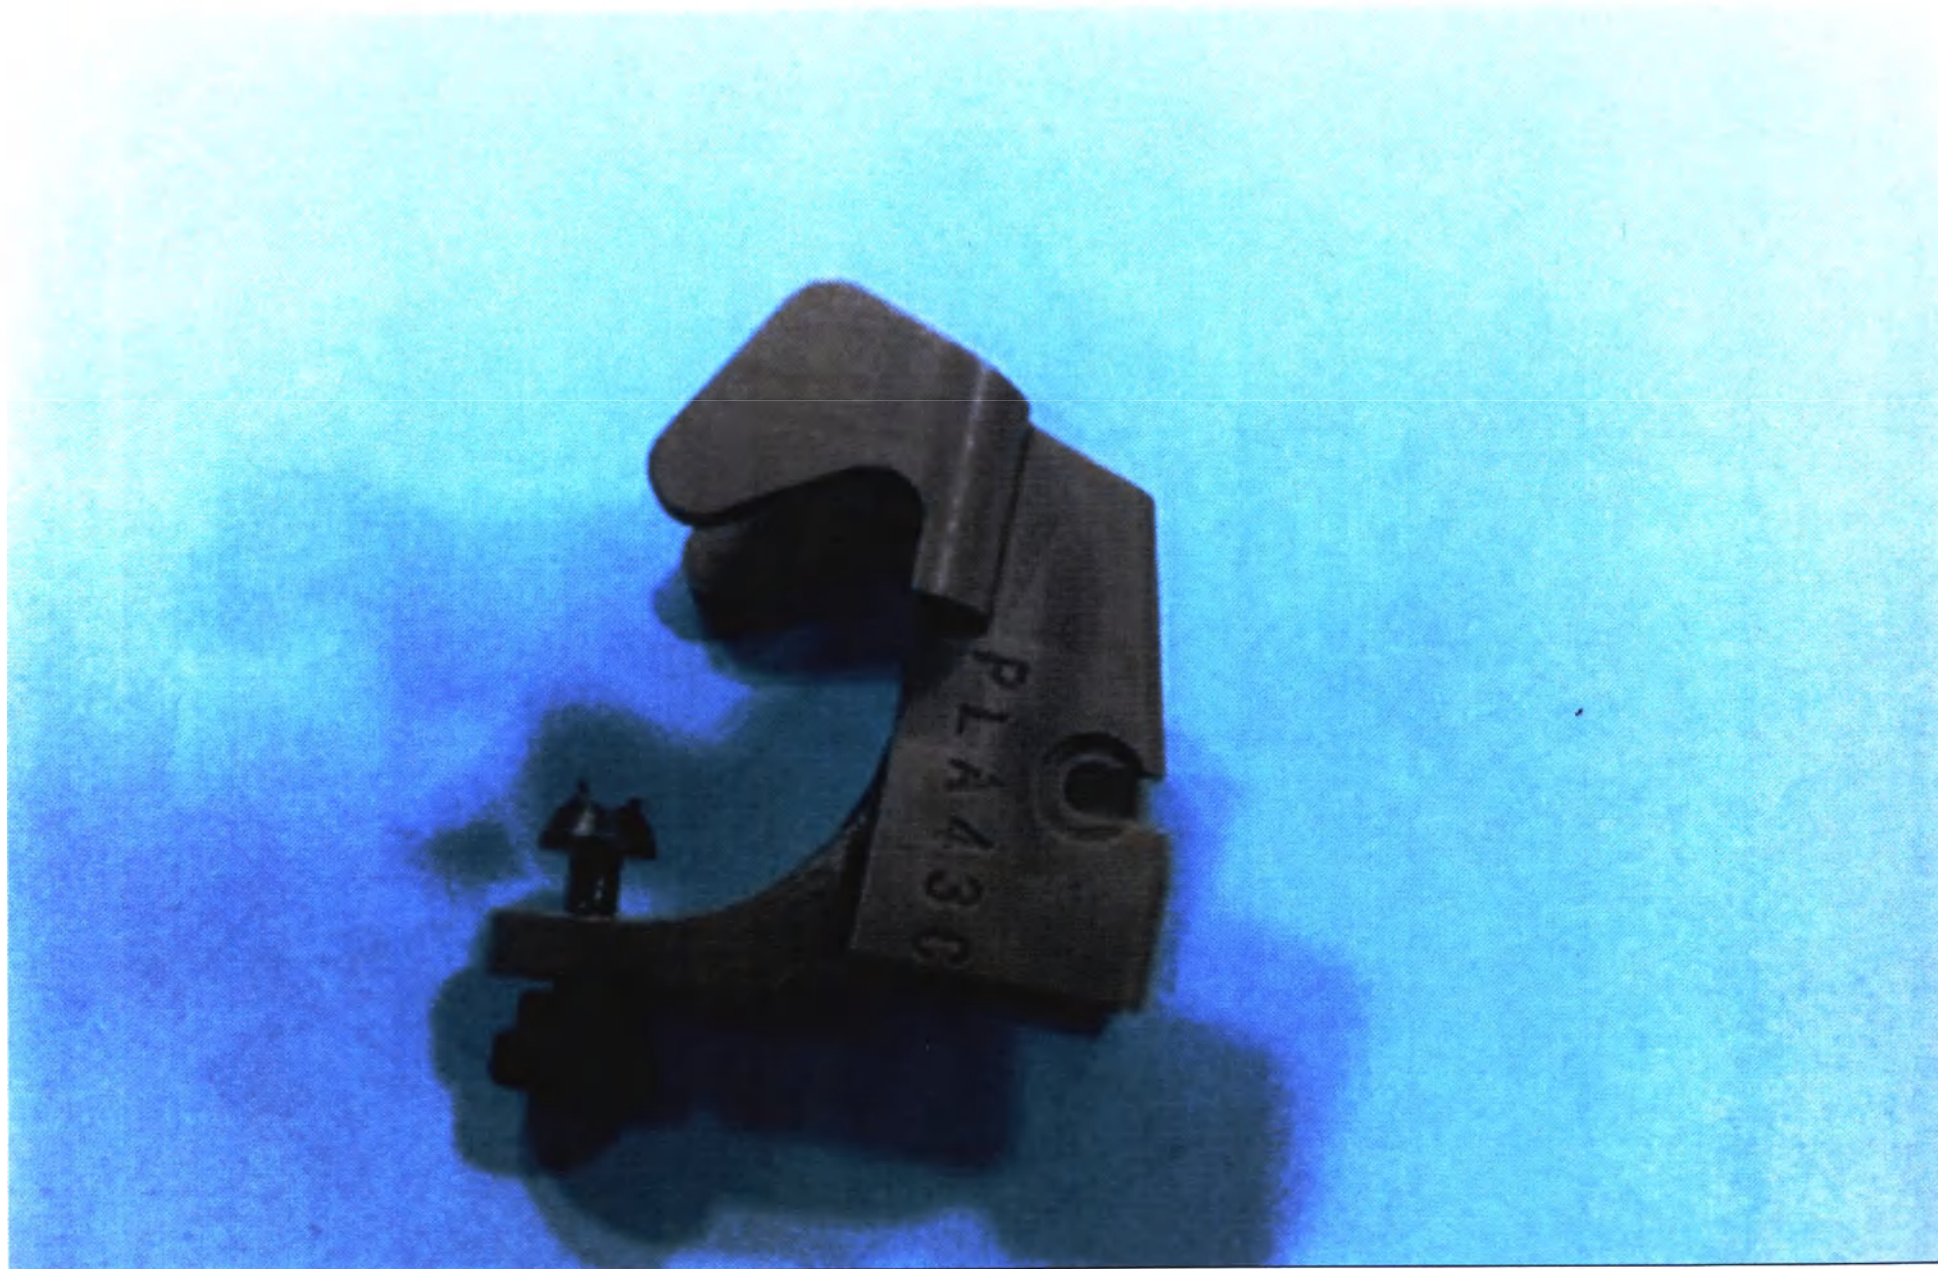


Фото 21. Набор опор направляющих многоразовых для ультразвукового датчика СА541: блок направляющий.



Фото 22. Устройство блокировочное.



Фото 23. Предохранитель 5АТ 250V 6.3x32 мм.

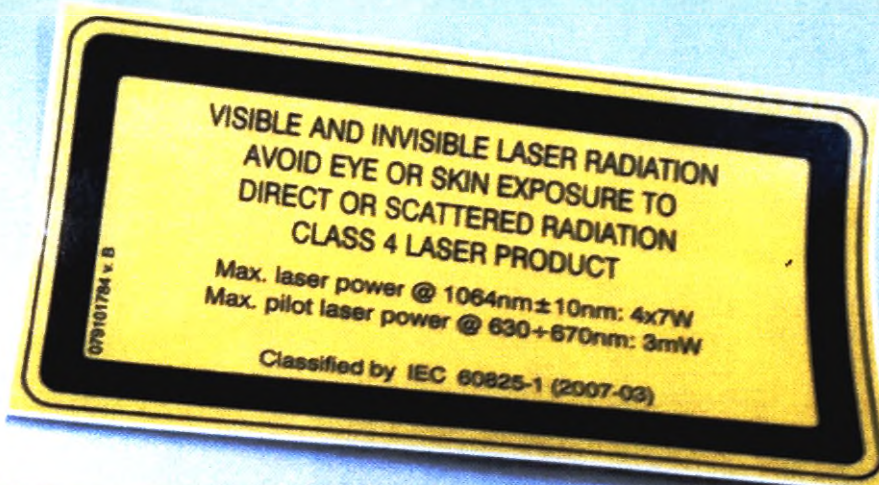


Фото 24. Табличка предупреждающая.



Фото 25. Ключ торцевой, размер 3 мм.



Фото 26. Винт ТССЕ М4х35 INOX.



Фото 27. Винт ТССЕ М4х40 INOX.

Всего пронумеровано, прошито и
скреплено

29

лист (-ов).

Генеральный директор

ООО «МедТестКонсалтинг»

Бунзя В. К.

