РАЗРАБОТКА МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ООО «Астра Лаб»

✉ Россия, 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа,
улица Уфимское шоссе, д. № 13 А, литер А7, помещения 1-3, эт.4
☎ (347) 246-50-86 многоканальный
e-mail: astra@astra-lab.info

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Астра Лаб»
_____ А.В. Карпухин
«02» июня 2020 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия «Коагулометр автоматический АК-37 по ТУ 9443-001-92819512-2012 с принадлежностями».

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Рис 1. Коагулометр автоматический АК-37 по ТУ 9443-001-92819512-2012 с принадлежностями.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рис 2. Блок анализатора.

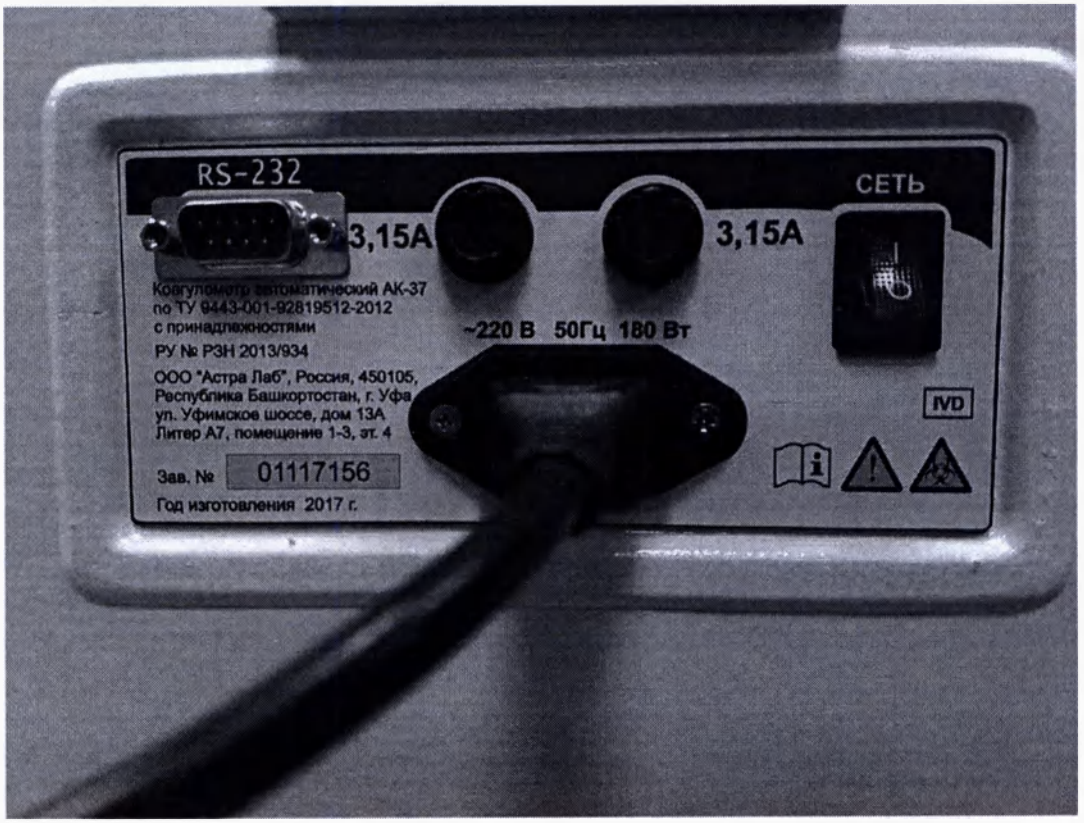

Рис 3. Маркировка блока анализатора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

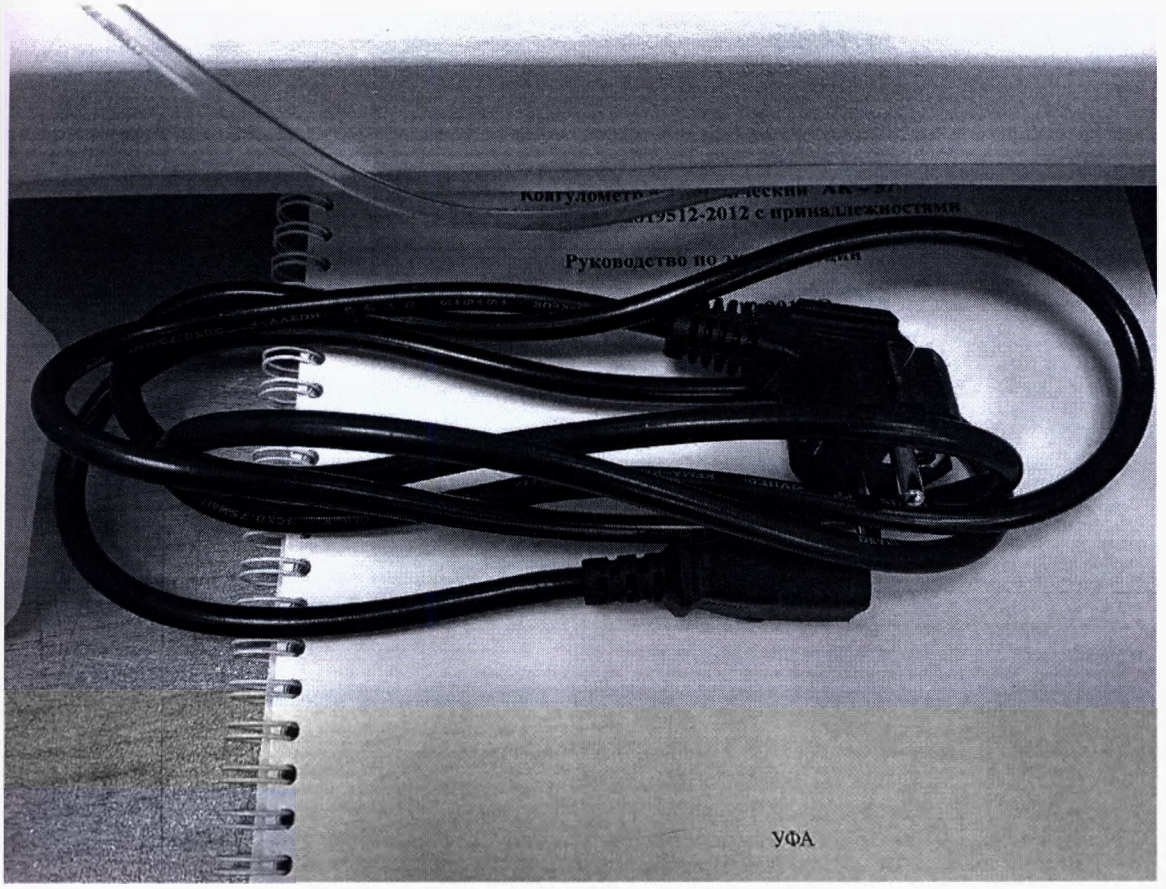

Рис 4. Кабель питания.

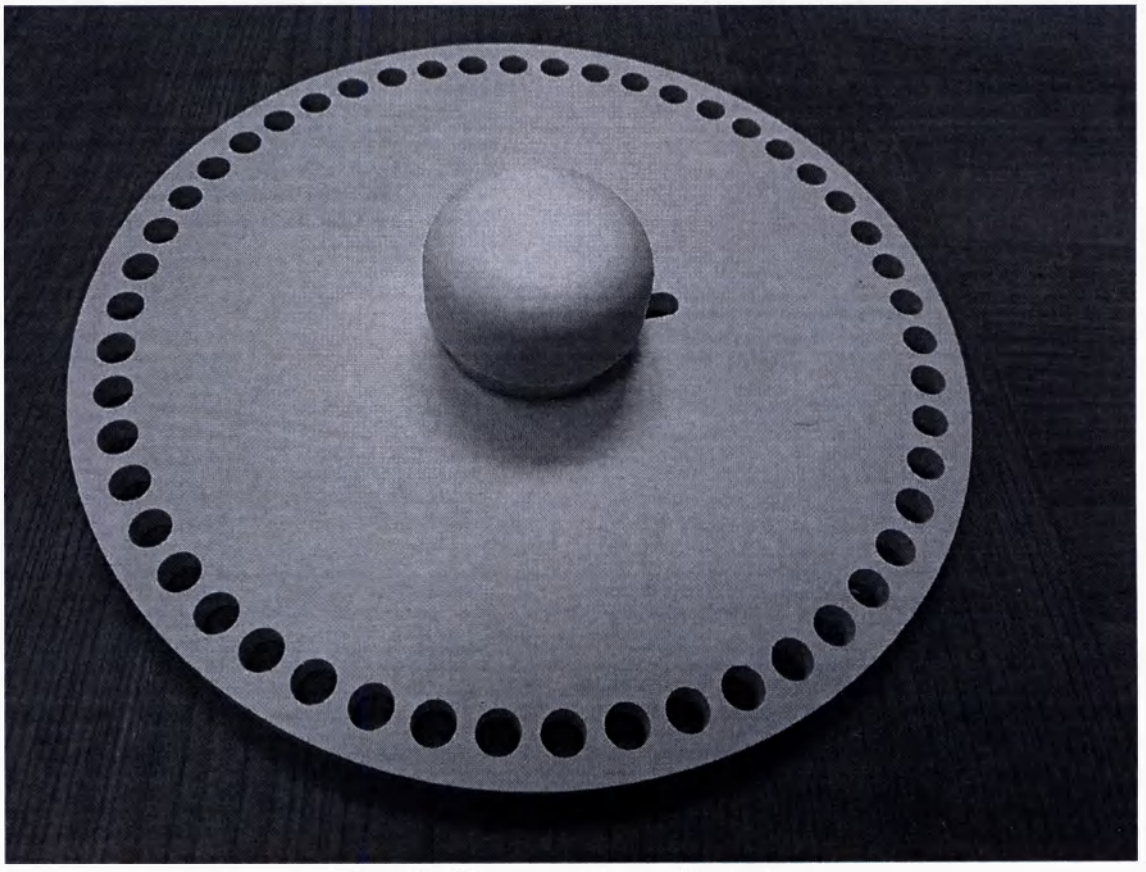

Рис 5. Реакционный диск.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

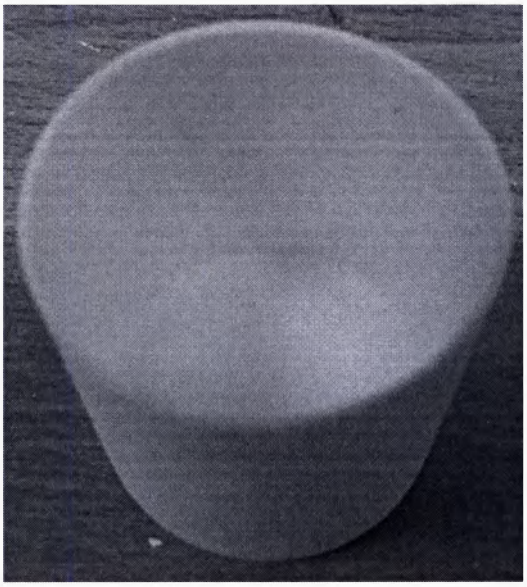

Рис 6. Емкость для промывающего раствора.

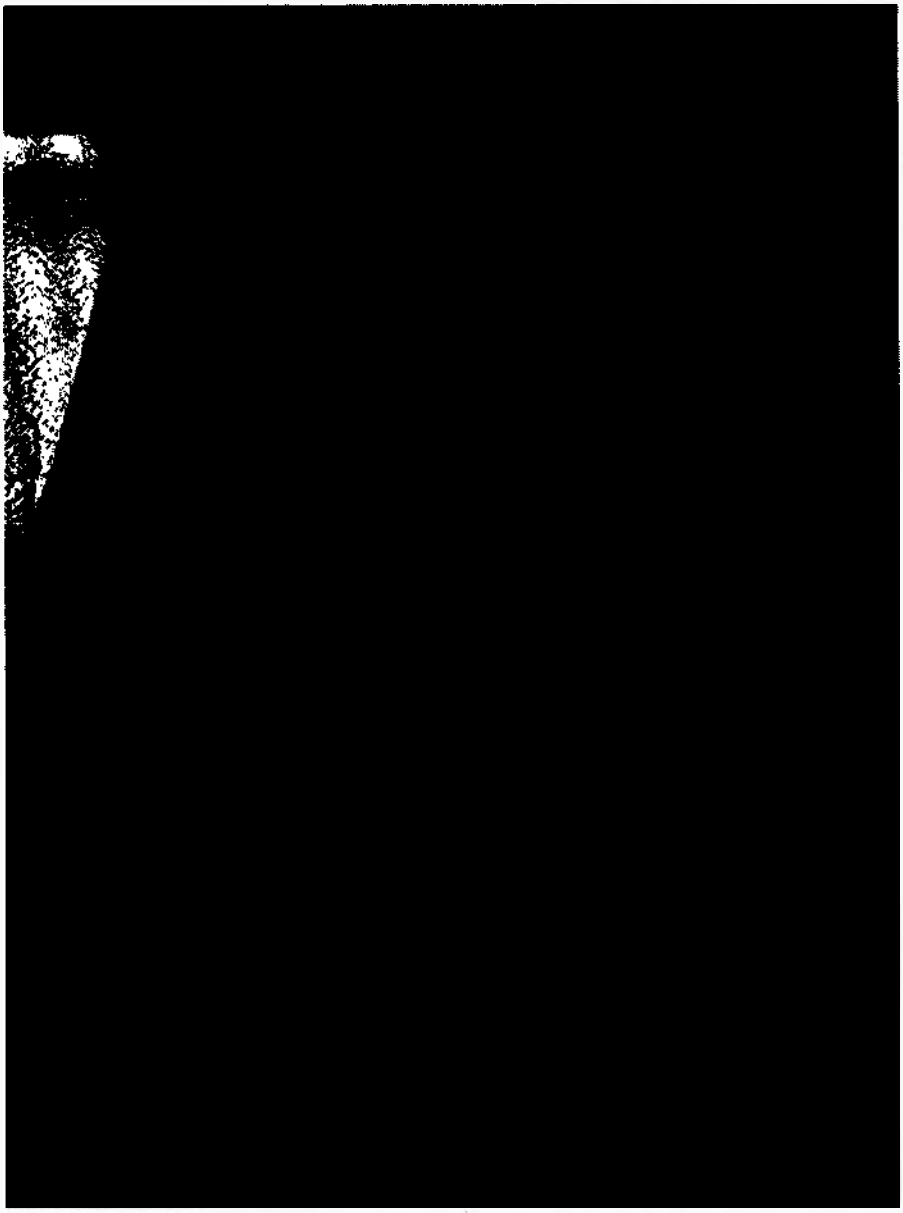

Рис 7. Канистра для дистиллированной воды.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

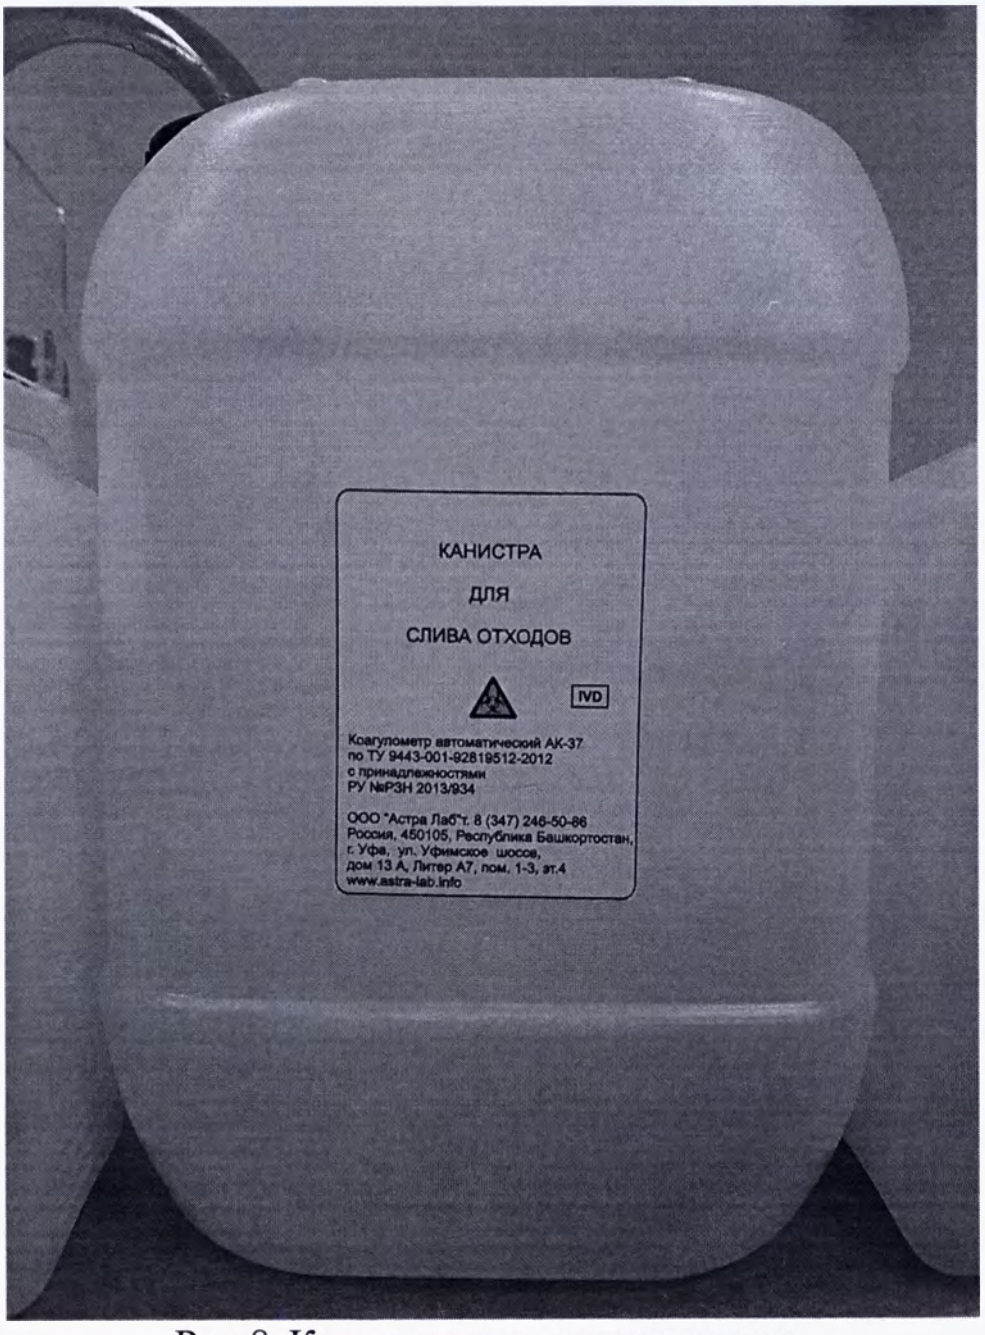

Рис 8. Канистра для слива отходов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

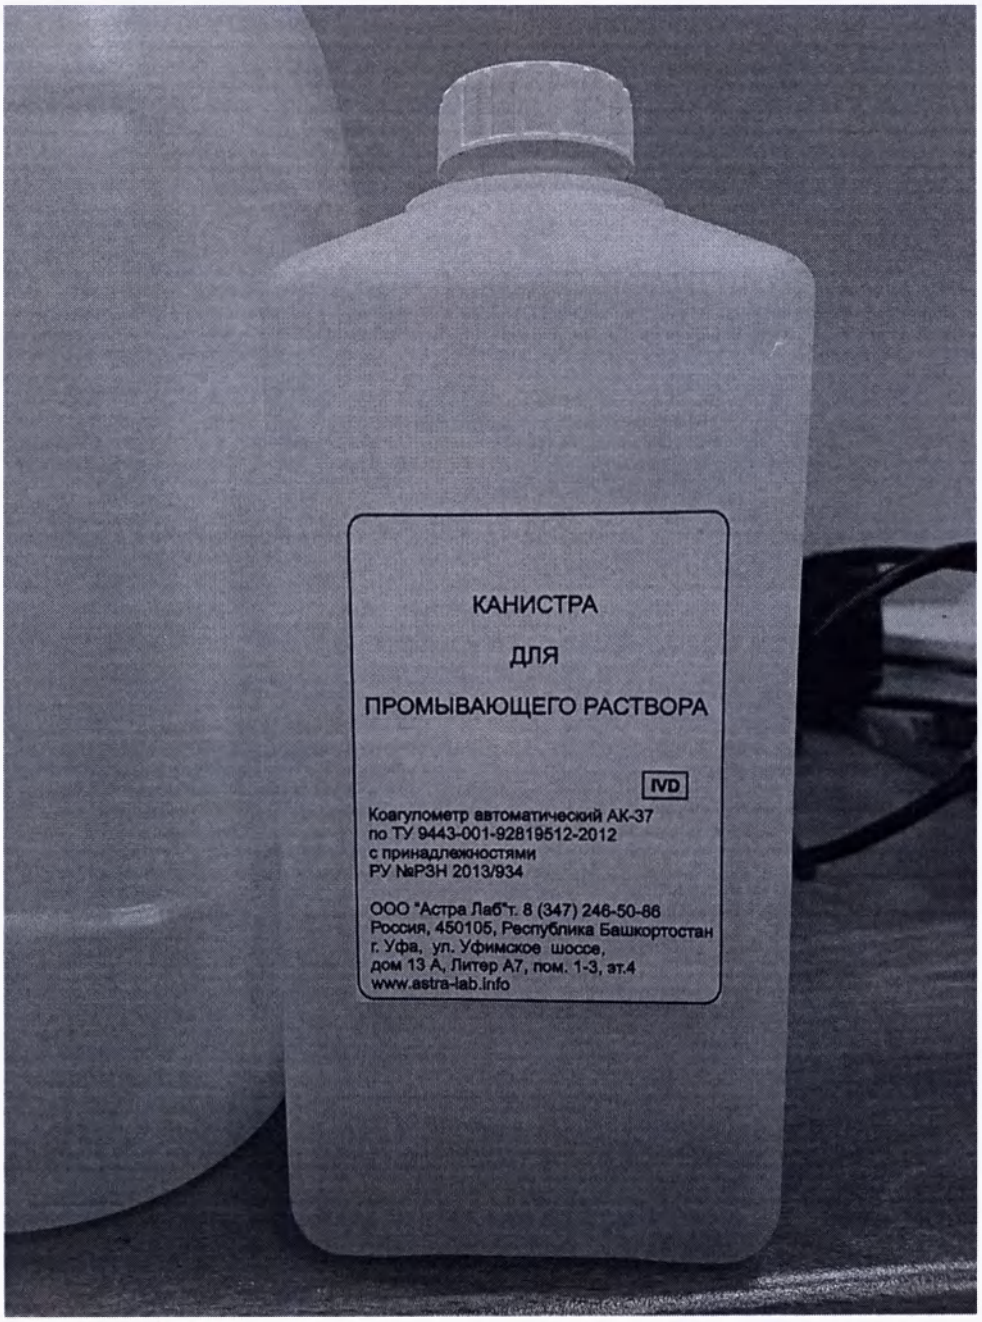

Рис 9. Канистра для промывающего раствора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

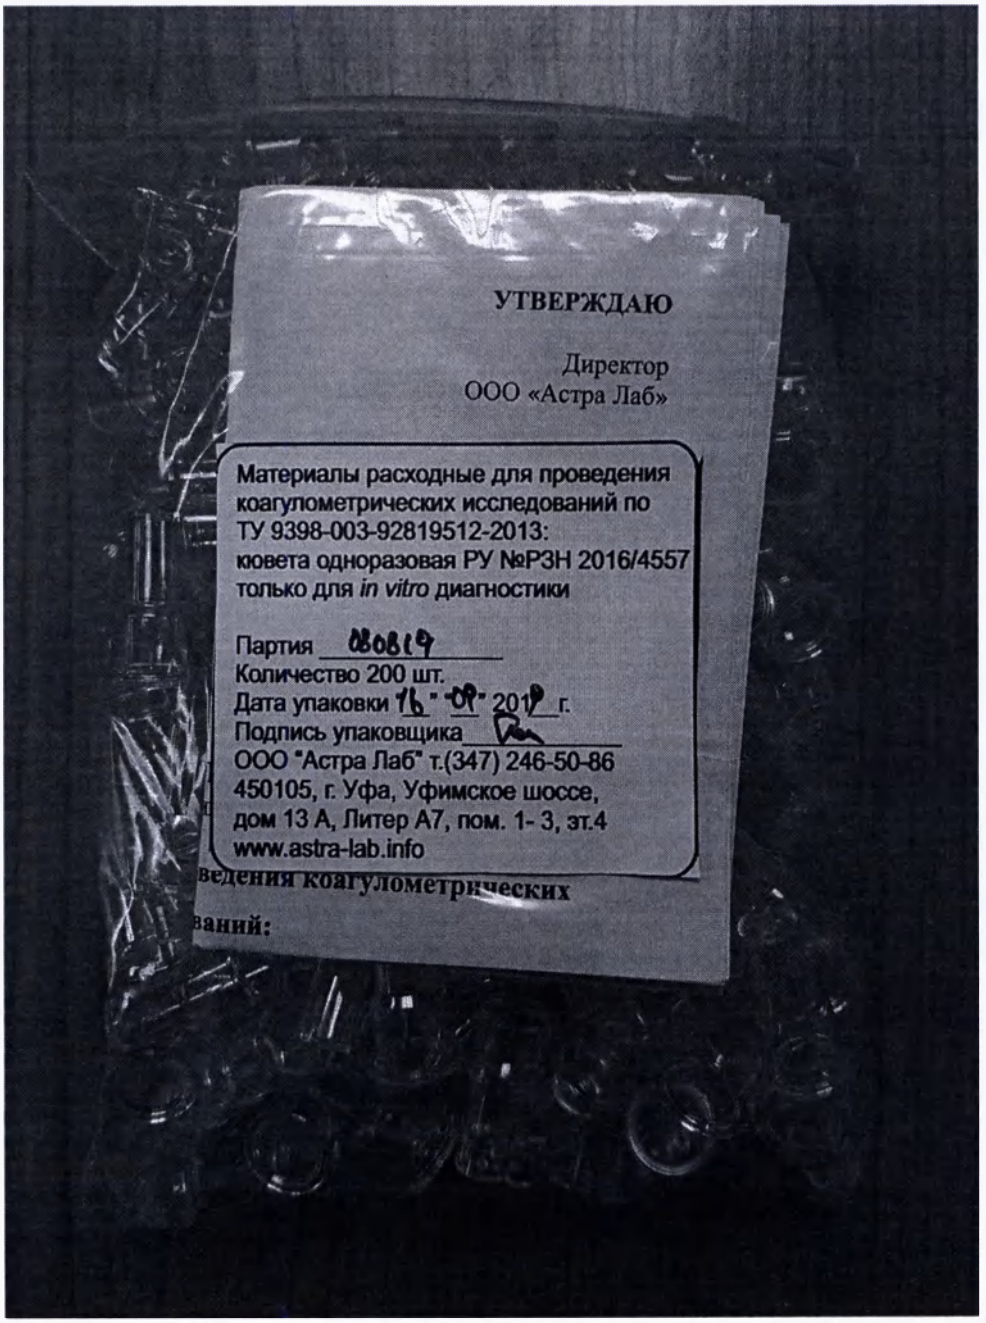

Рис 10. Кювета одноразовая (Материалы расходные для проведения коагулометрических исследований по ТУ 9398-003-92819512-2013: кювета одноразовая и магнитная мешалка РУ № РЗН 2016/4557)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

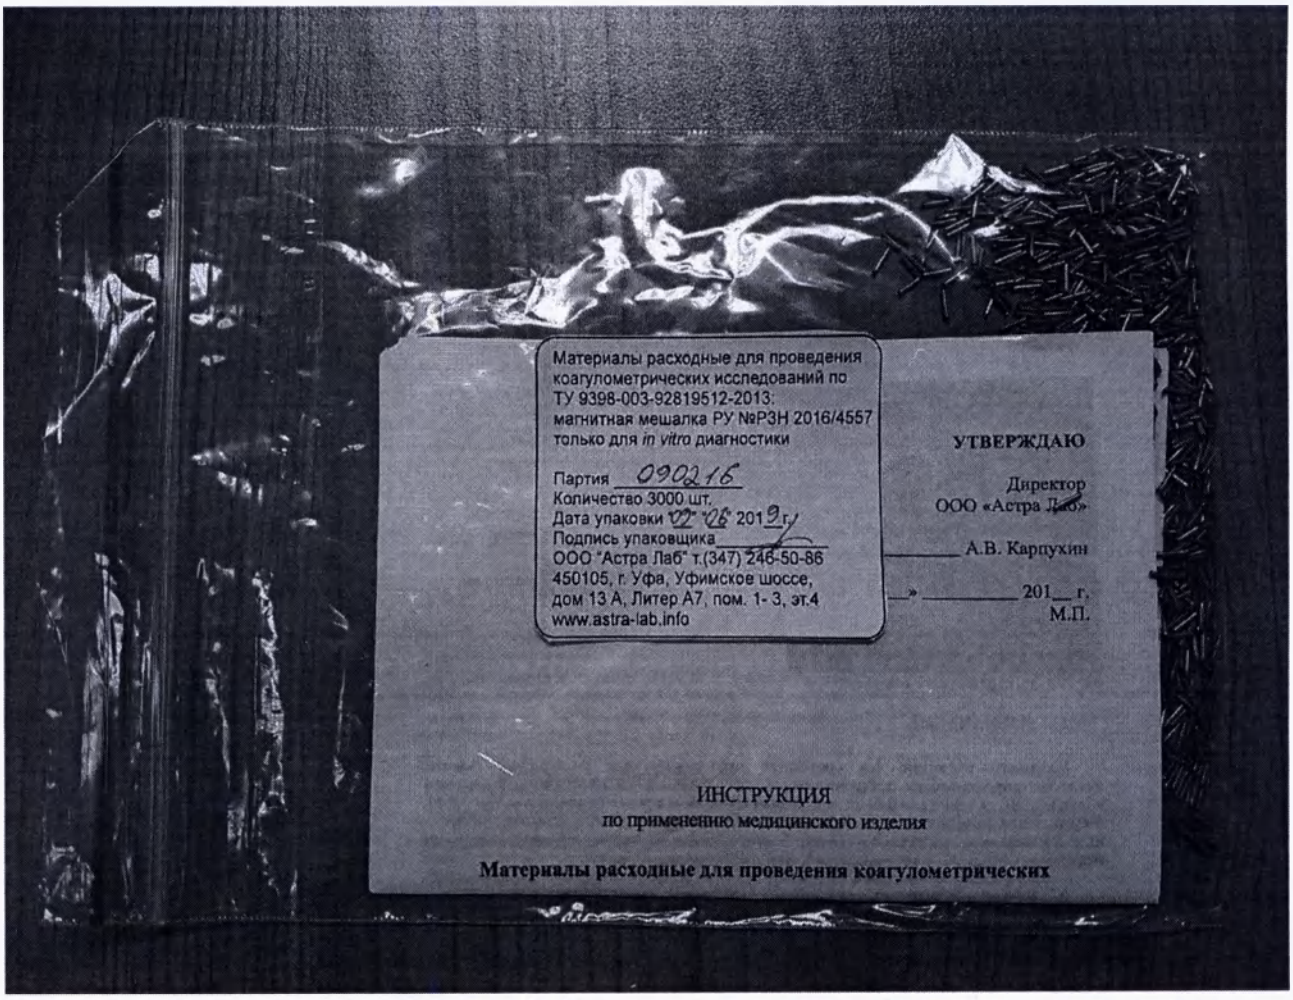

Рис 11. Магнитная мешалка (Материалы расходные для проведения коагулометрических исследований по ТУ 9398-003-92819512-2013: кювета одноразовая и магнитная мешалка РУ № РЗН 2016/4557)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

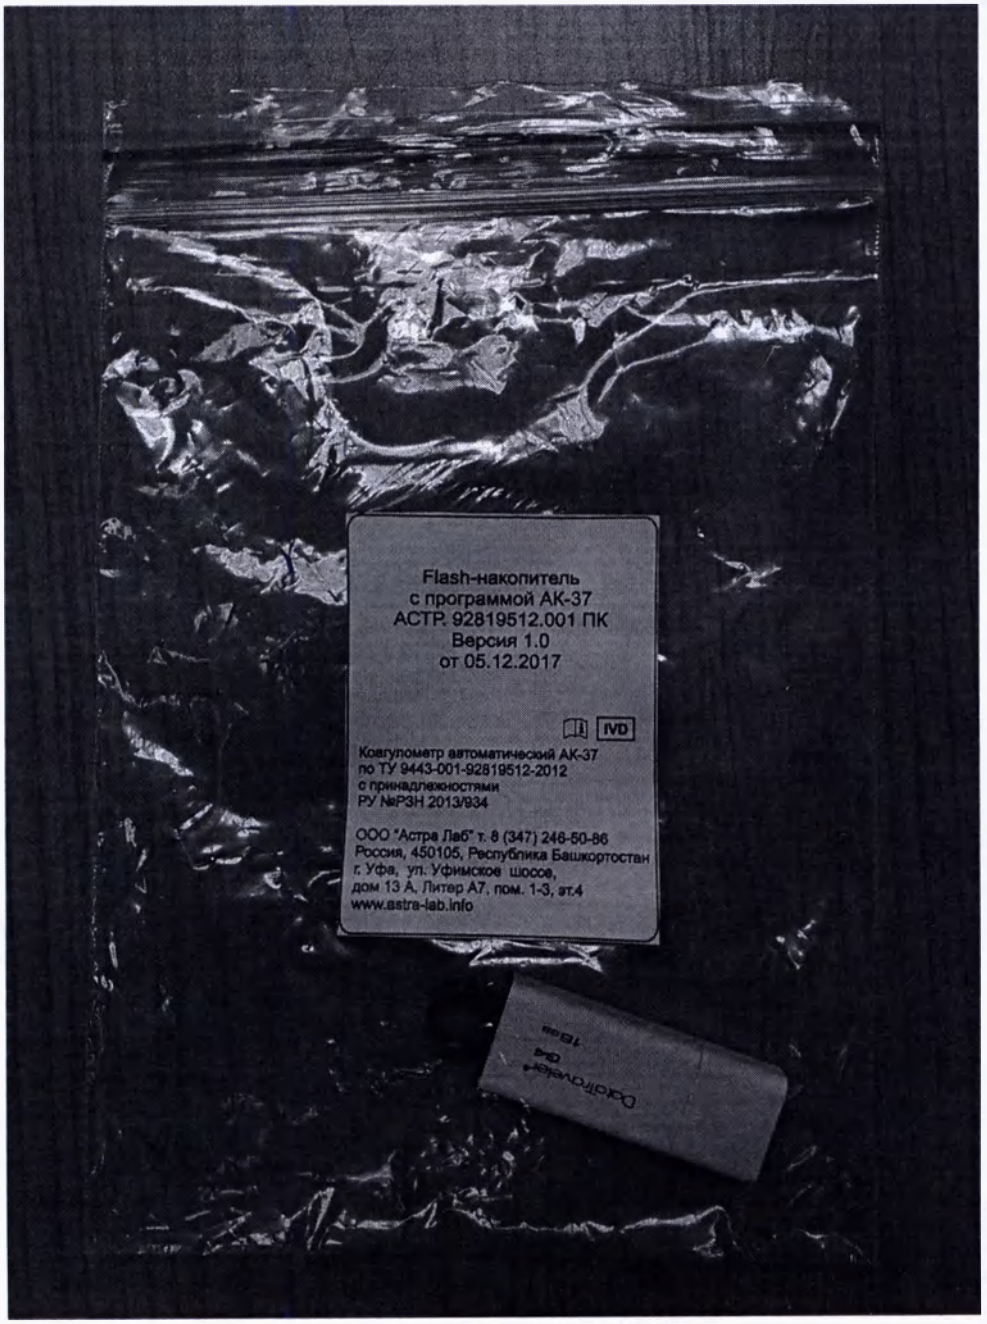

Рис 12. Flash-накопитель с программой АК-37.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рис 13. Транспортная тара.

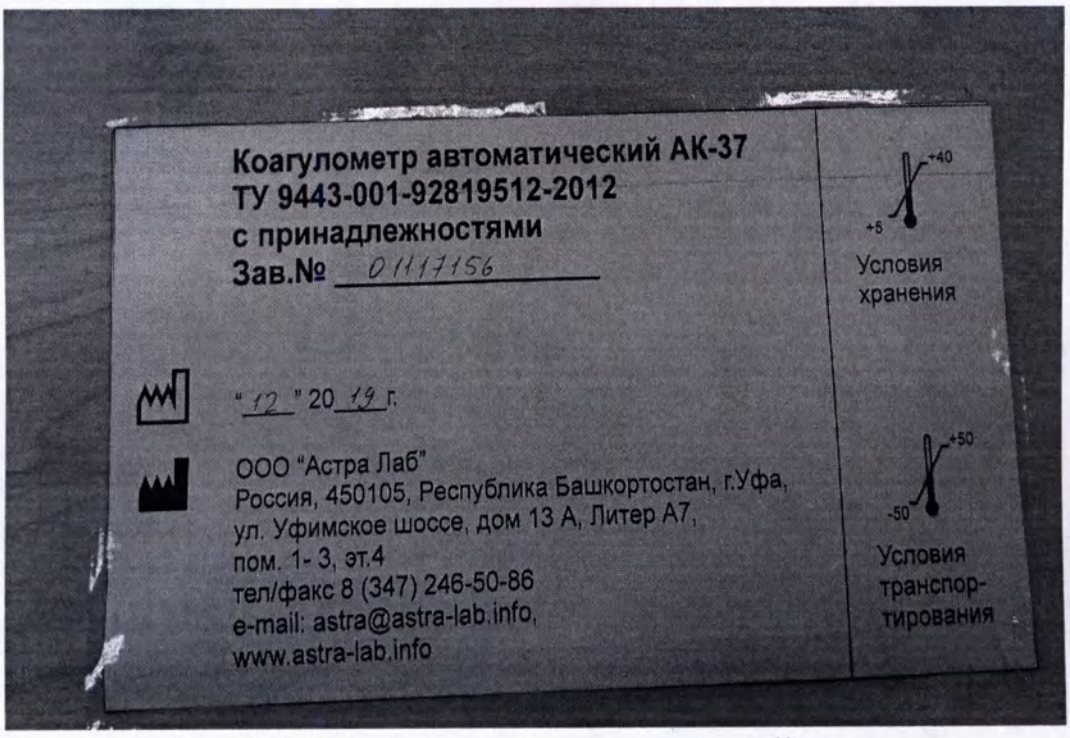

Рис 14. Маркировка транспортной тары.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито и пронумеровано
11 (одиннадцать) листов
Директор ООО «Астра Лаб»
_____ Карпухин А.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU