



РАЗРАБОТКА МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ООО «Астра Лаб»

✉ Россия, 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа,
улица Уфимское шоссе, д. № 13 А, литер А7, помещения 1-3, эт. 4
☎ (347) 246-50-86 многоканальный
📧 e-mail: astra@astra-lab.info

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Астра Лаб»

А.В. Карпухин

2021 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия
«Анализатор гематологический автоматический АСТРА-19 по
ТУ 26.60.12-006-92819512-2020».

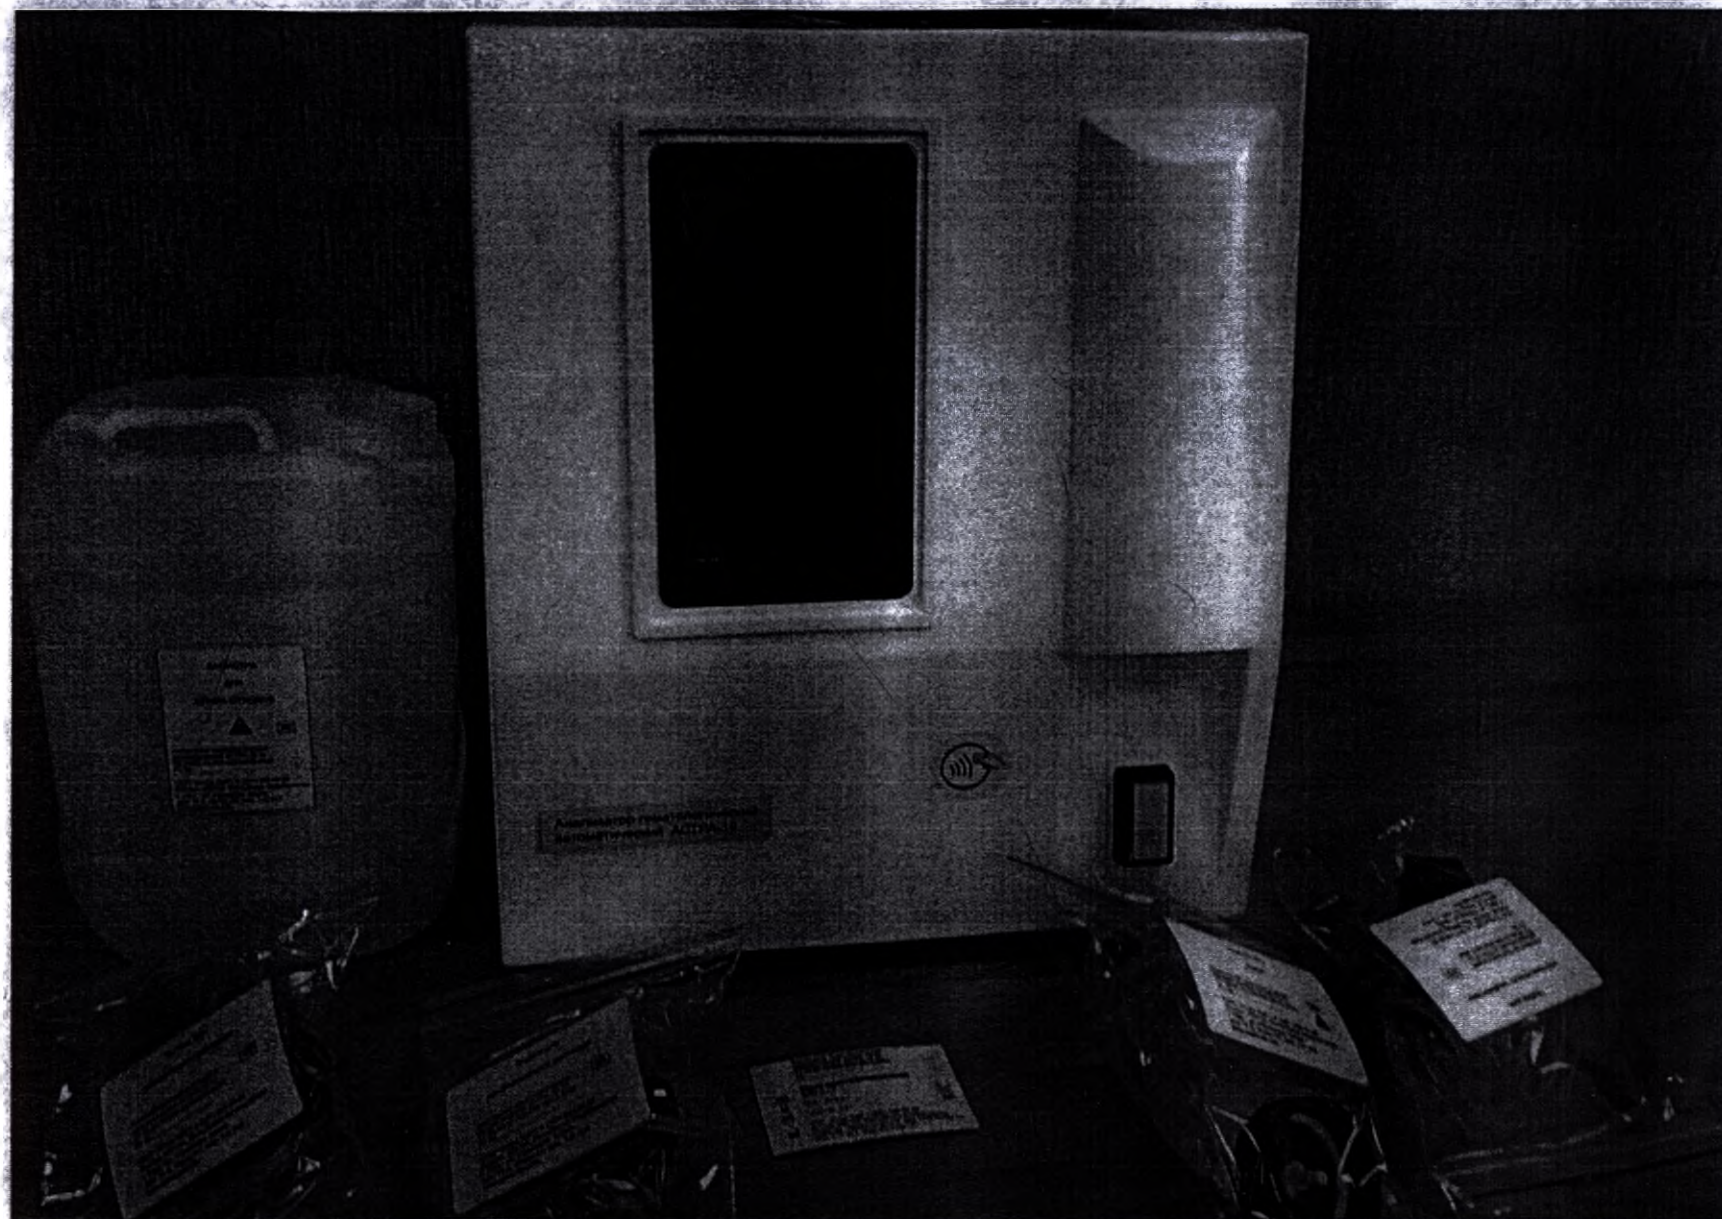


Рисунок 1. Общий вид медицинского изделия.



Рисунок 2. Блок анализатора вид спереди.



Рисунок 3. Блок анализатора, задняя панель.

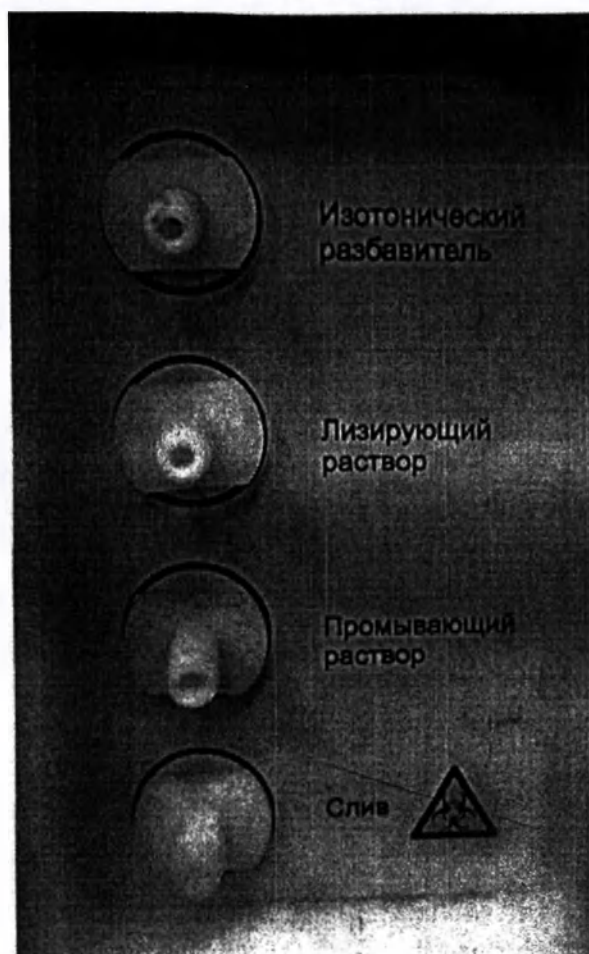


Рисунок 4. Консоль подключения трубки для промывающего раствора и трубки для слива отходов на задней части блока анализатора.



Рисунок 5. Кабель питания.

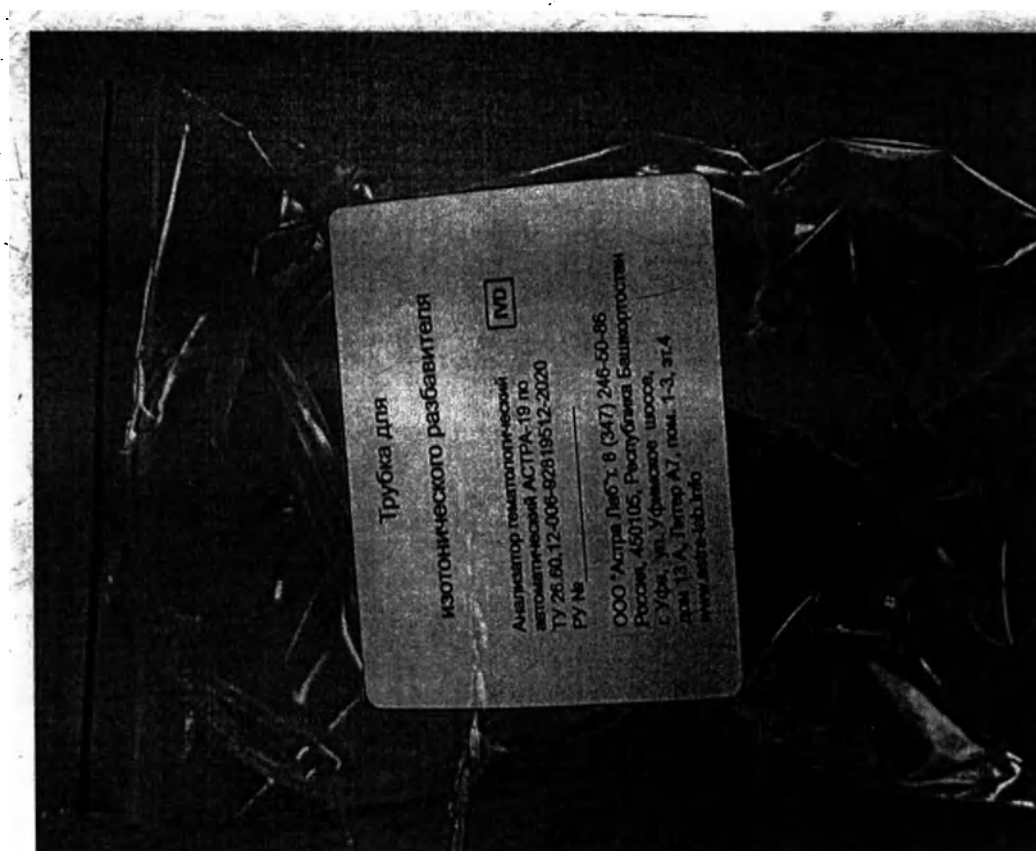


Рисунок 6. Трубка для изотонического разбавителя.



Рисунок 7. Трубка для лизирующего раствора.

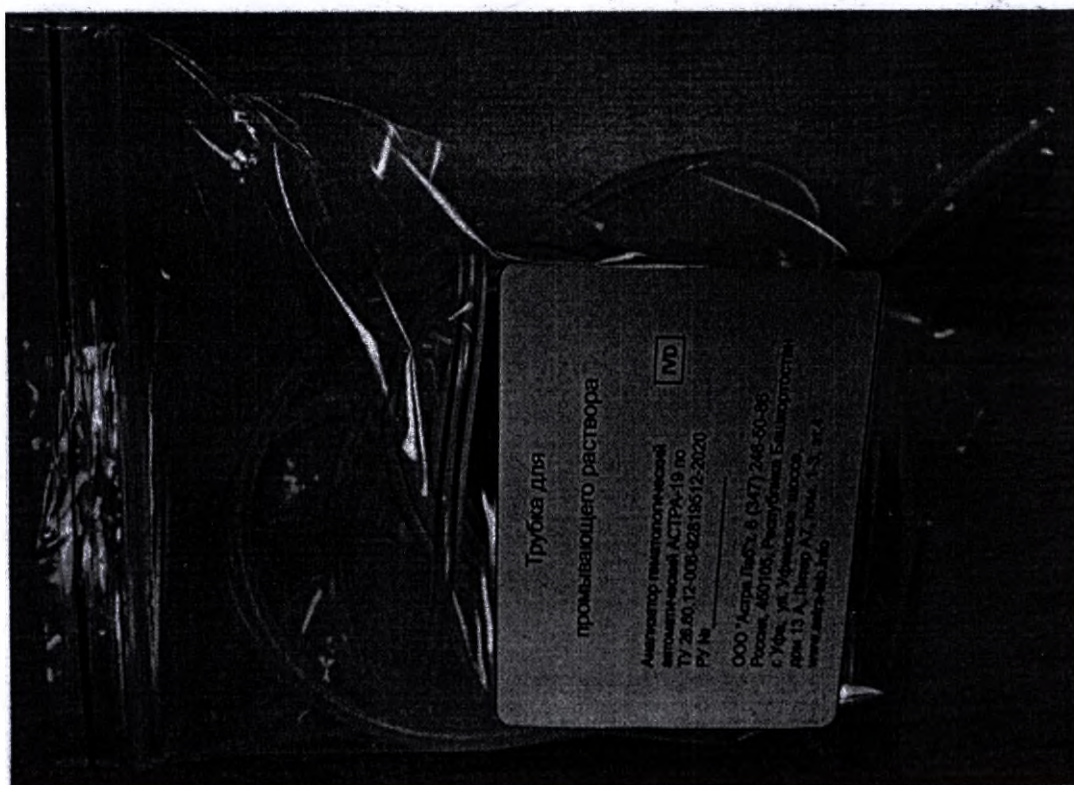


Рисунок 8. Трубка для промывающего раствора.

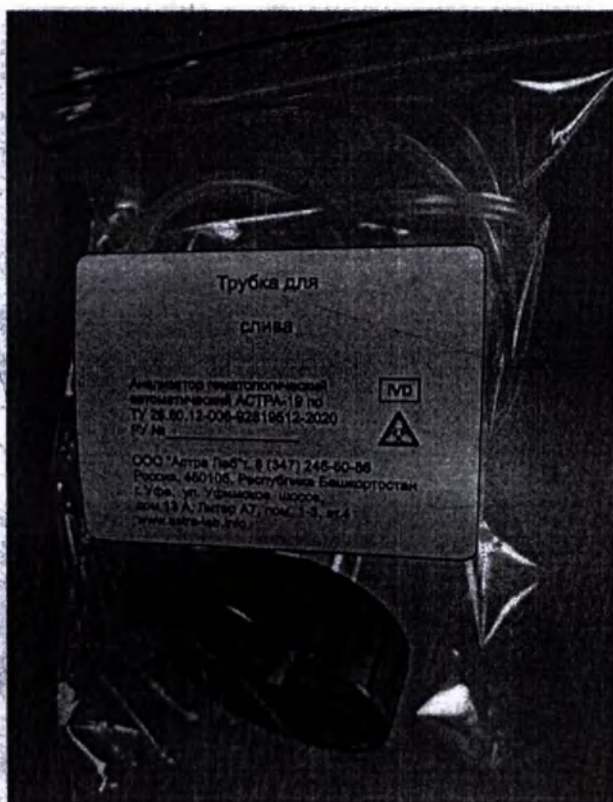


Рисунок 9. Трубка для слива в индивидуальной потребительской упаковке и без неё.

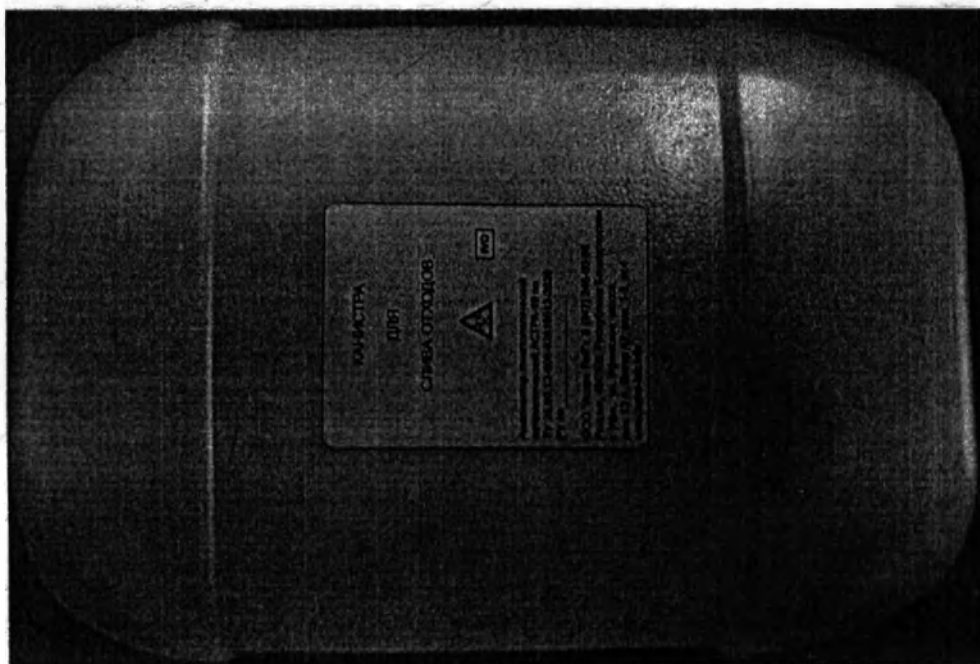


Рисунок 10. Канистра для слива отходов.



Рисунок 11. Карта идентификационная.

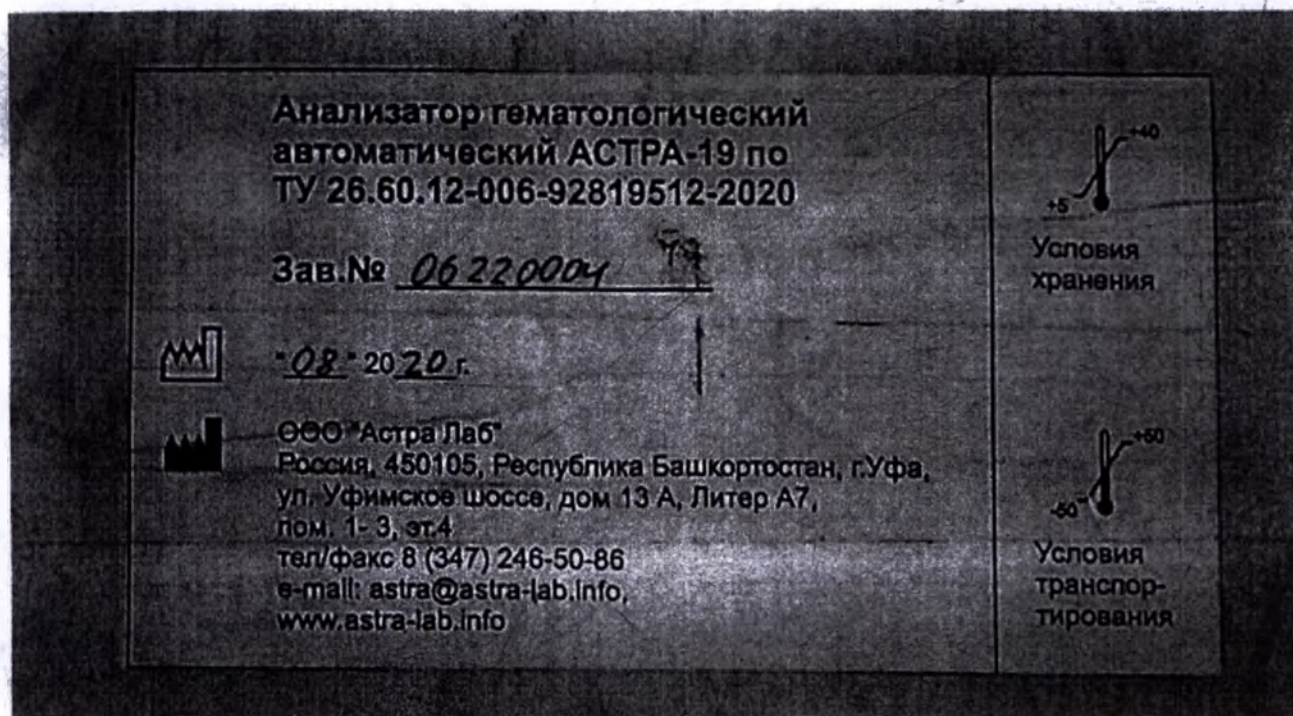


Рисунок 12. Маркировка транспортной тары.

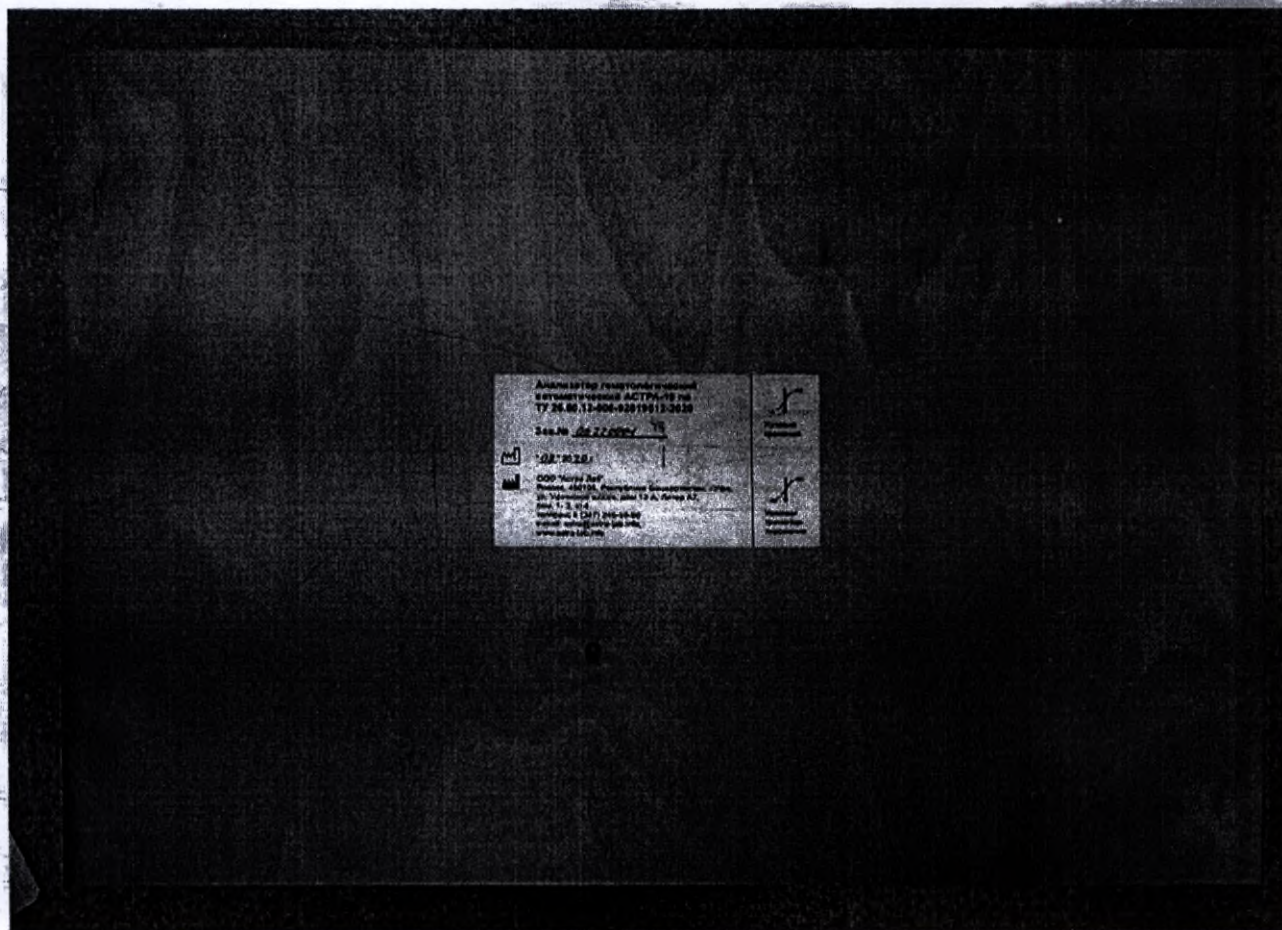


Рисунок 13. Транспортная тара.