



РАЗРАБОТКА МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ООО «Астра Лаб»

✉ Россия, 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа,
улица Уфимское шоссе, д. № 13 А, литер А7, помещения 1-3, эт.4

☎ (347) 246-50-86 многоканальный

📧 e-mail: astra@astra-lab.info

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Астра Лаб»


А.В. Карпухин

2019 г.
М.П.



Фотографические изображения медицинского изделия:

«Кювета для проведения коагулометрических исследований, одноразовая, нестерильная по
ТУ 22.29.29-003-92819512-2019 в вариантах комплектации»

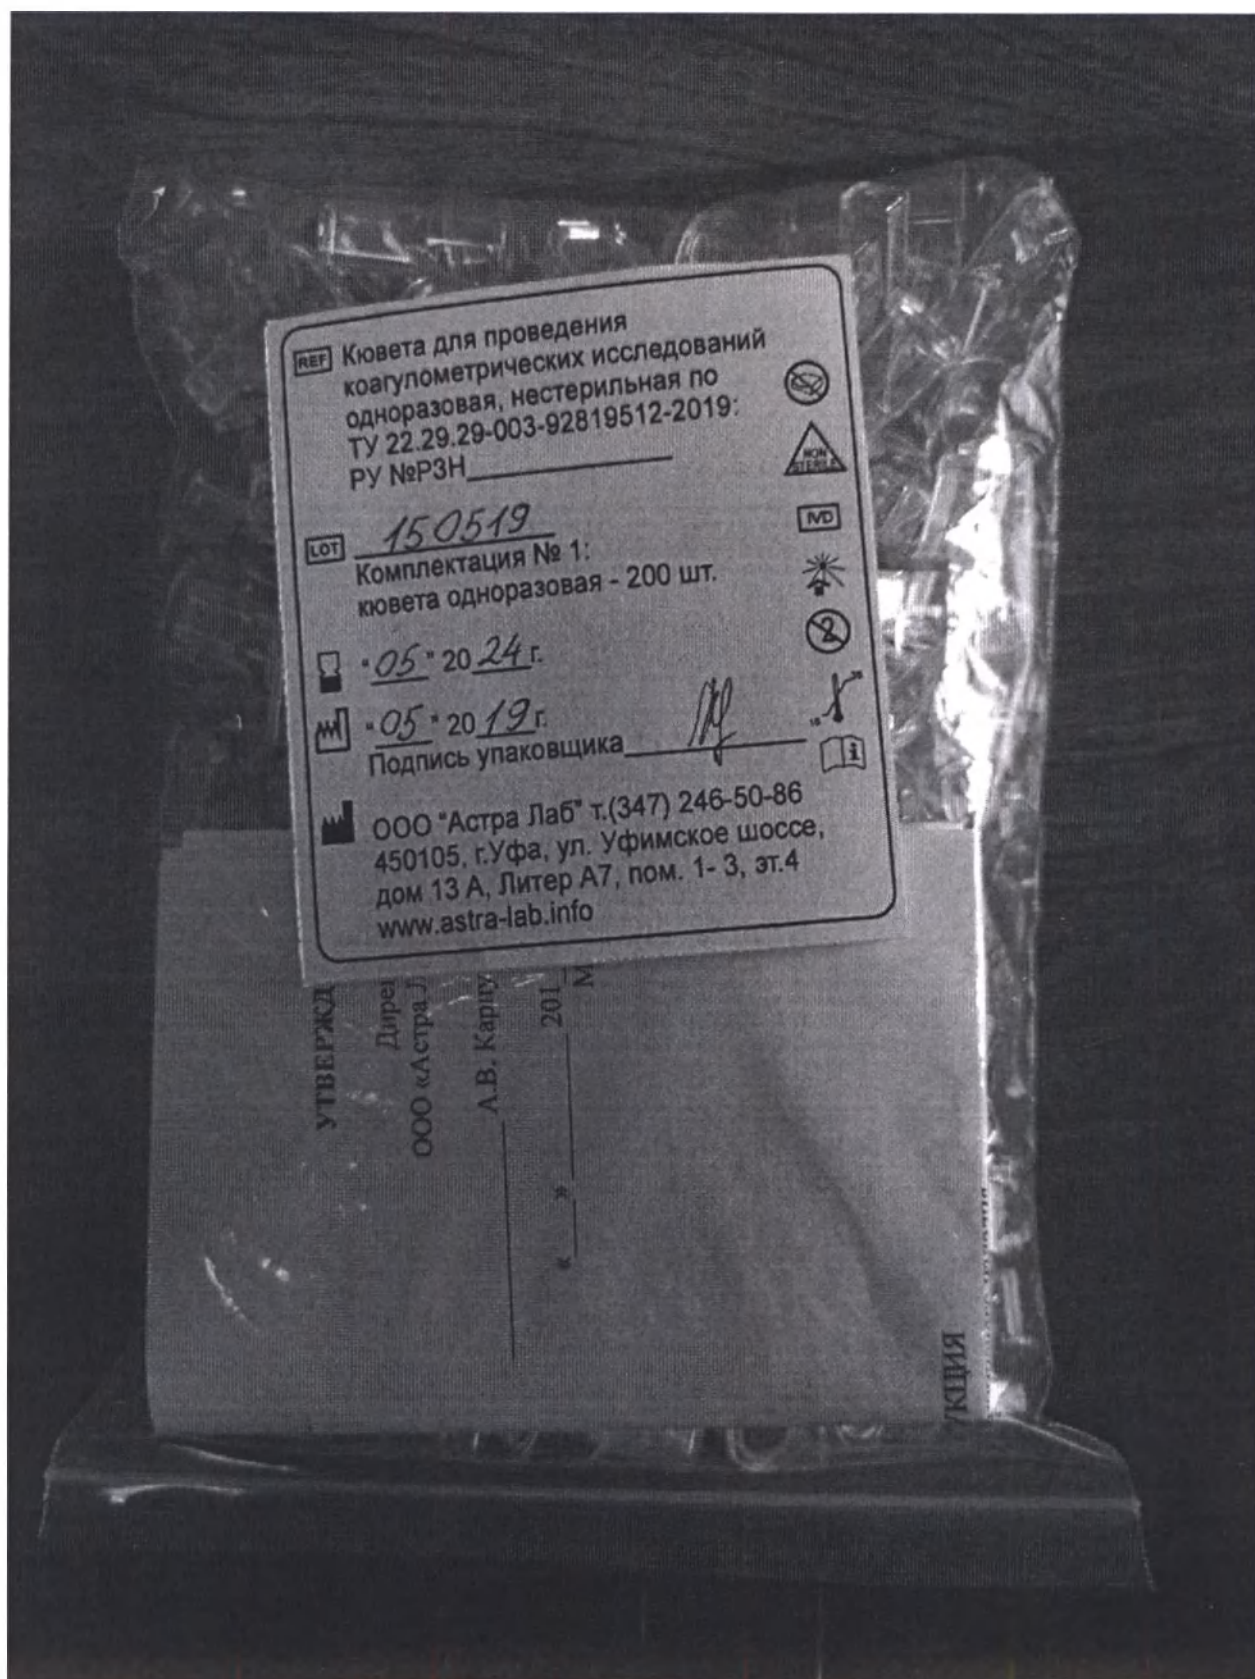

REF Кювета для проведения
 коагулометрических исследований
 одноразовая, нестерильная по
 ТУ 22.29.29-003-92819512-2019:
 РУ №РЗН _____

LOT 150519
 Комплектация № 1:
 кювета одноразовая - 200 шт.

*05 * 20 24 г.
 *05 * 20 19 г.
 Подпись упаковщика _____

ООО "Астра Лаб" т.(347) 246-50-86
 450105, г.Уфа, ул. Уфимское шоссе,
 дом 13 А, Литер А7, пом. 1- 3, эт.4
www.astra-lab.info




Рис 1. Фотографическое изображение медицинского изделия - Кювета для проведения коагулометрических исследований, одноразовая, нестерильная по ТУ 22.29.29-003-92819512-2019 в варианте комплектации «1».

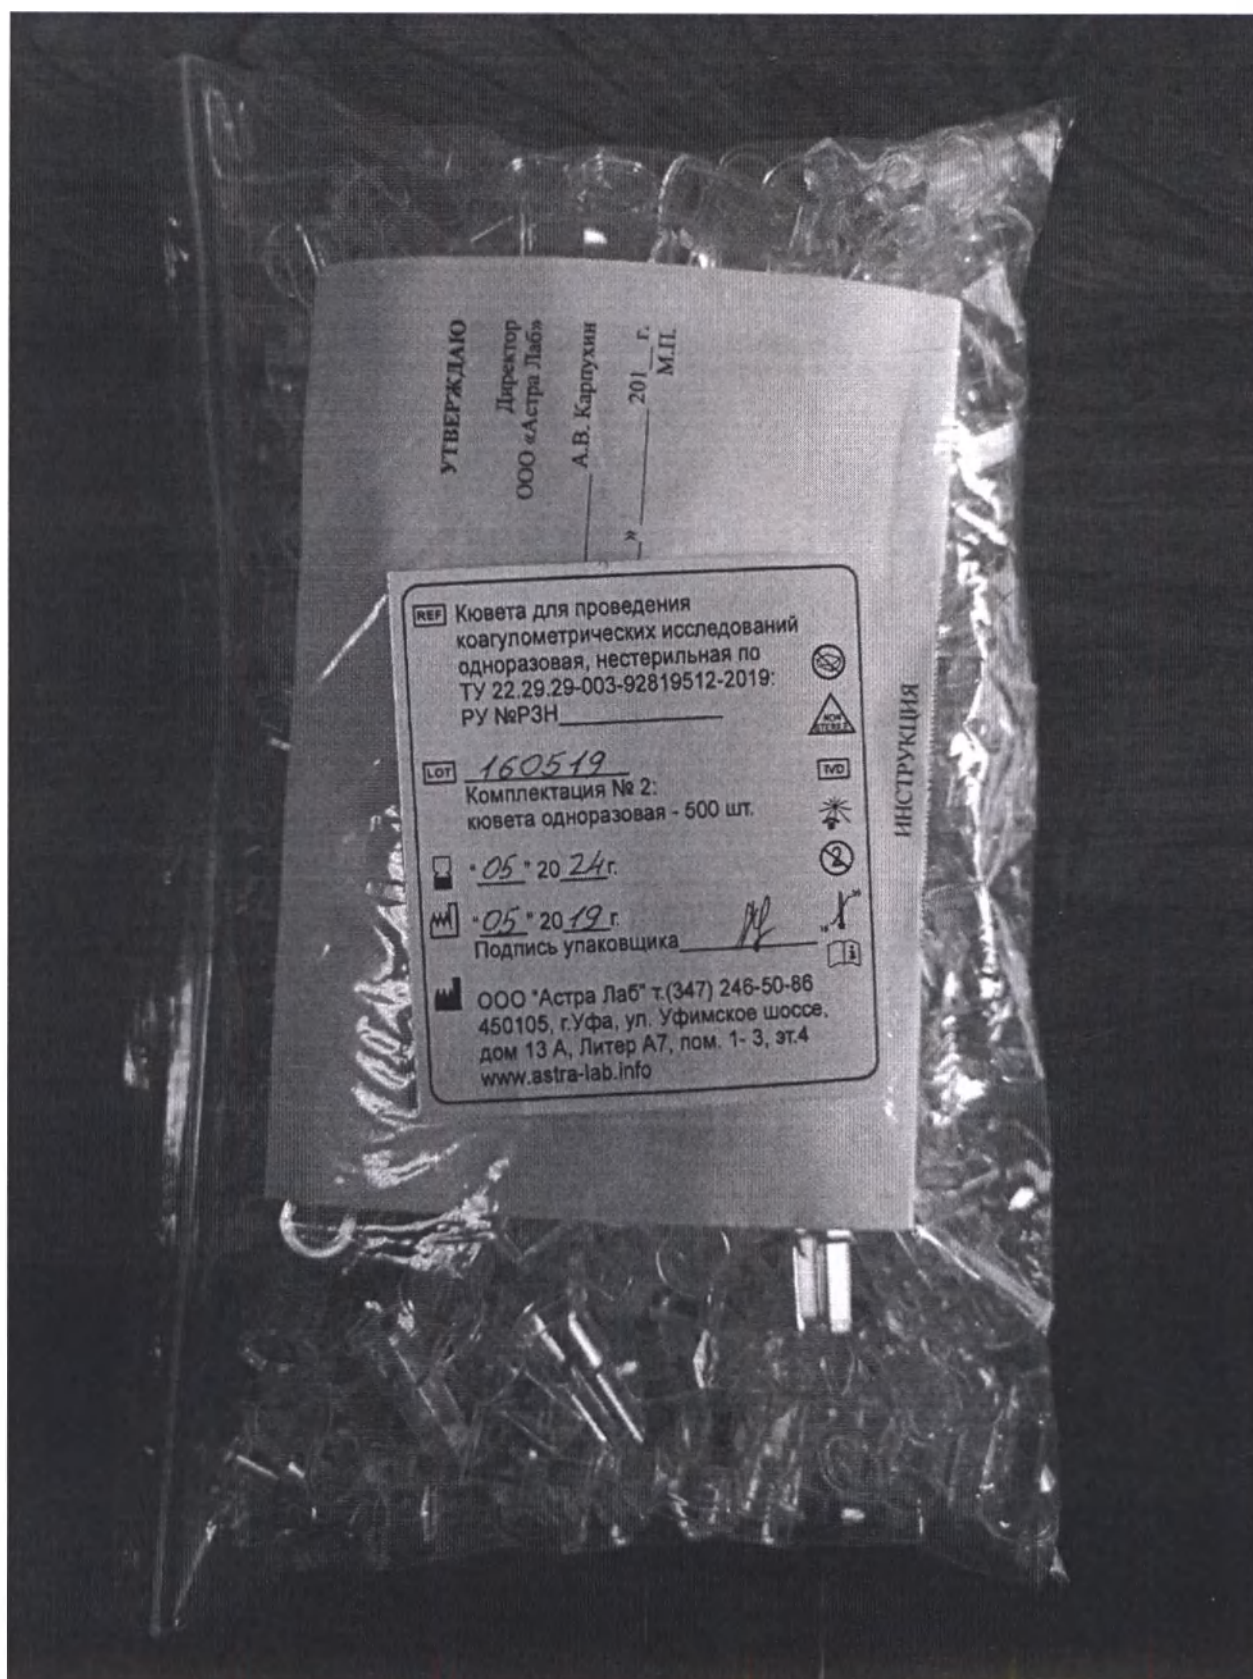


Рис 2. Фотографическое изображение медицинского изделия - Кювета для проведения коагулометрических исследований, одноразовая, нестерильная по ТУ 22.29.29-003-92819512-2019 в варианте комплектации «2».

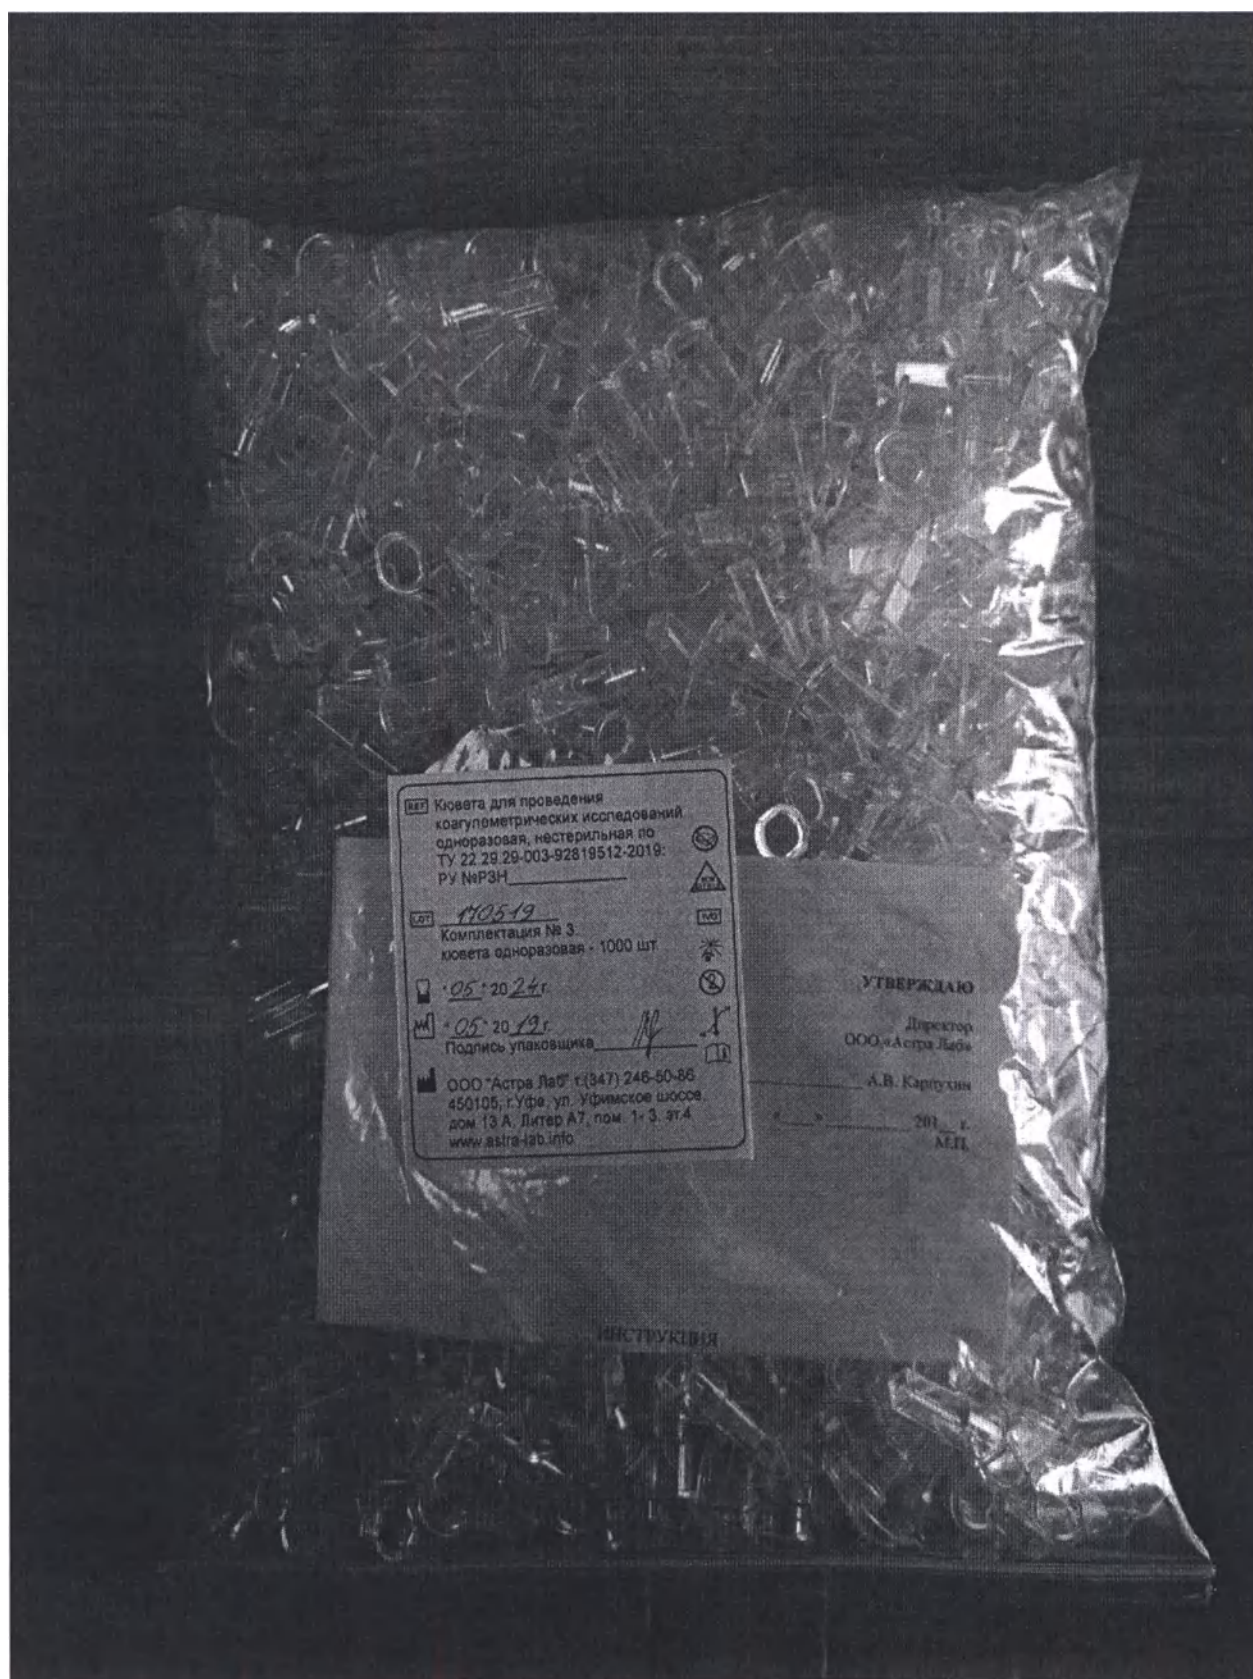


Рис 3. Фотографическое изображение медицинского изделия - Кювета для проведения коагулометрических исследований, одноразовая, нестерильная по ТУ 22.29.29-003-92819512-2019 в варианте комплектации «3».

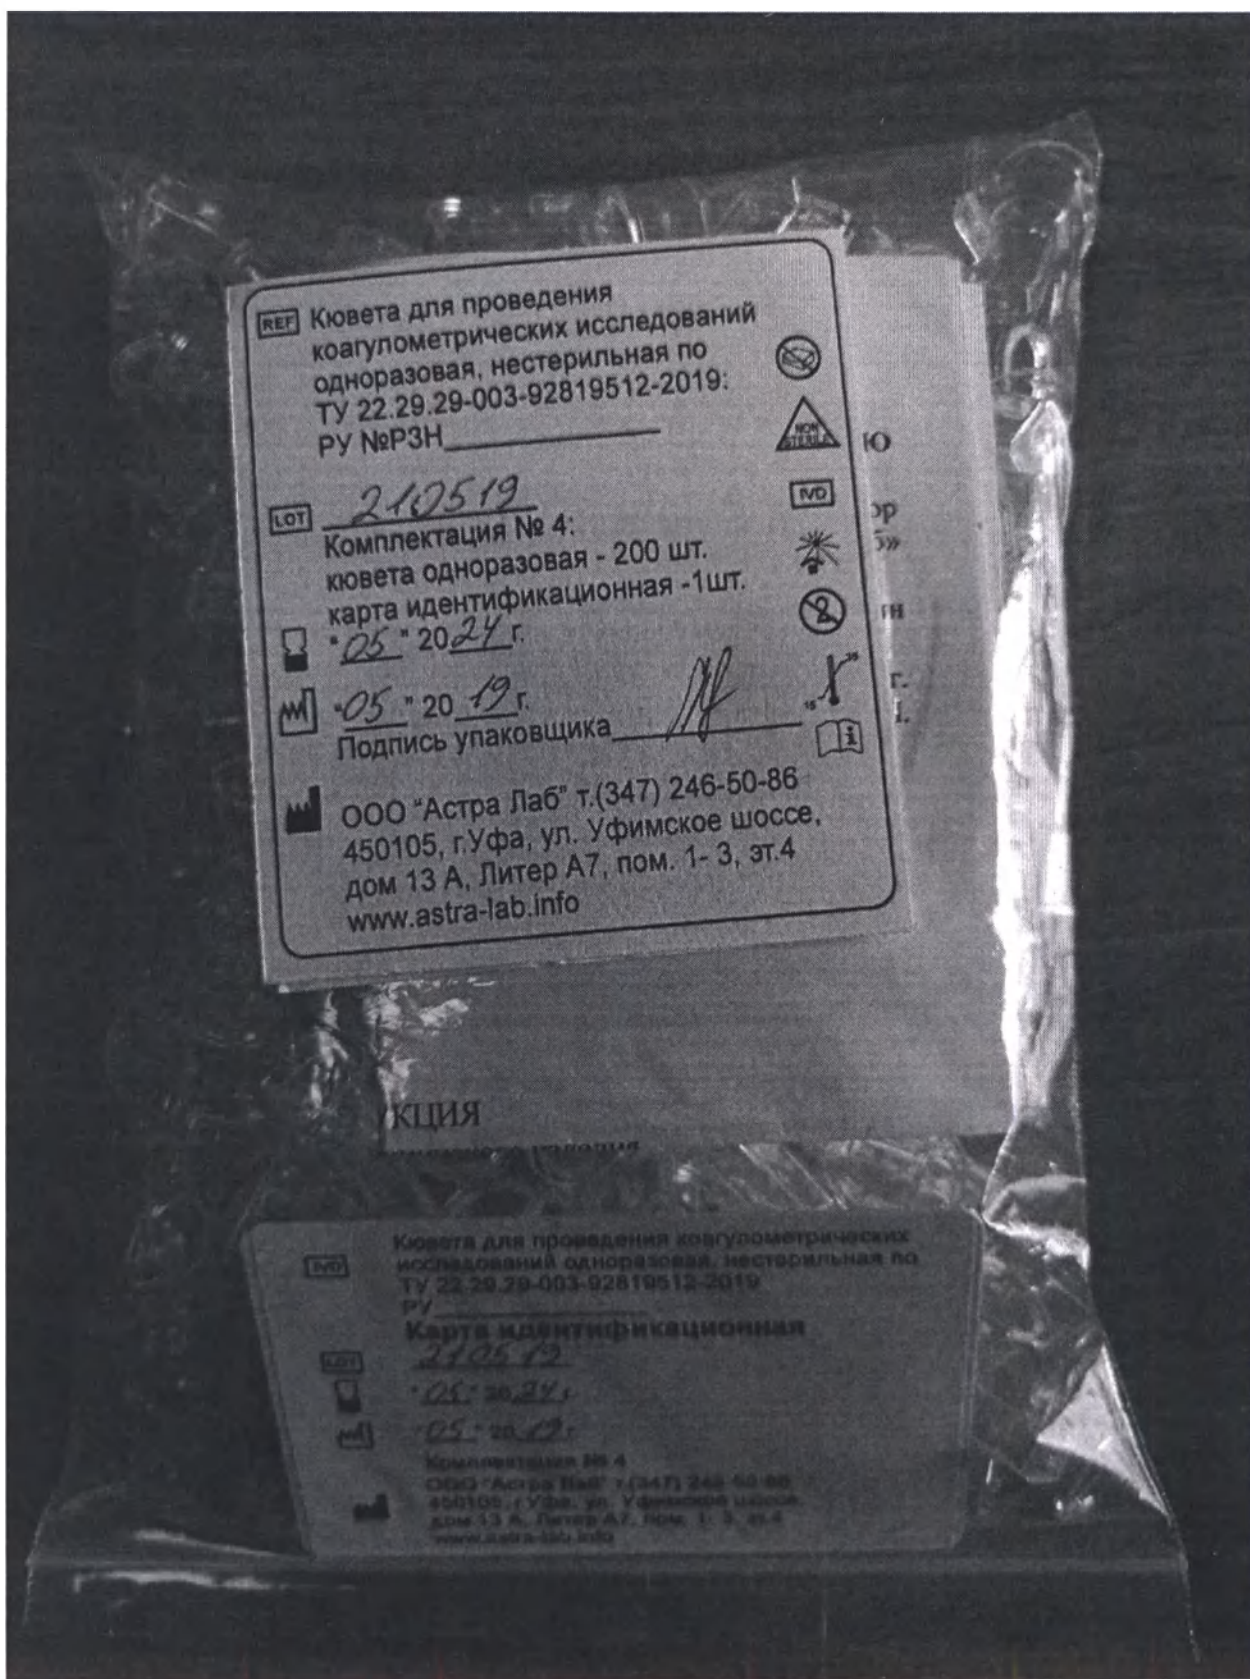


Рис 4. Фотографическое изображение медицинского изделия - Кювета для проведения коагулометрических исследований, одноразовая, нестерильная по

819512-2019 в варианте комплектации «4».

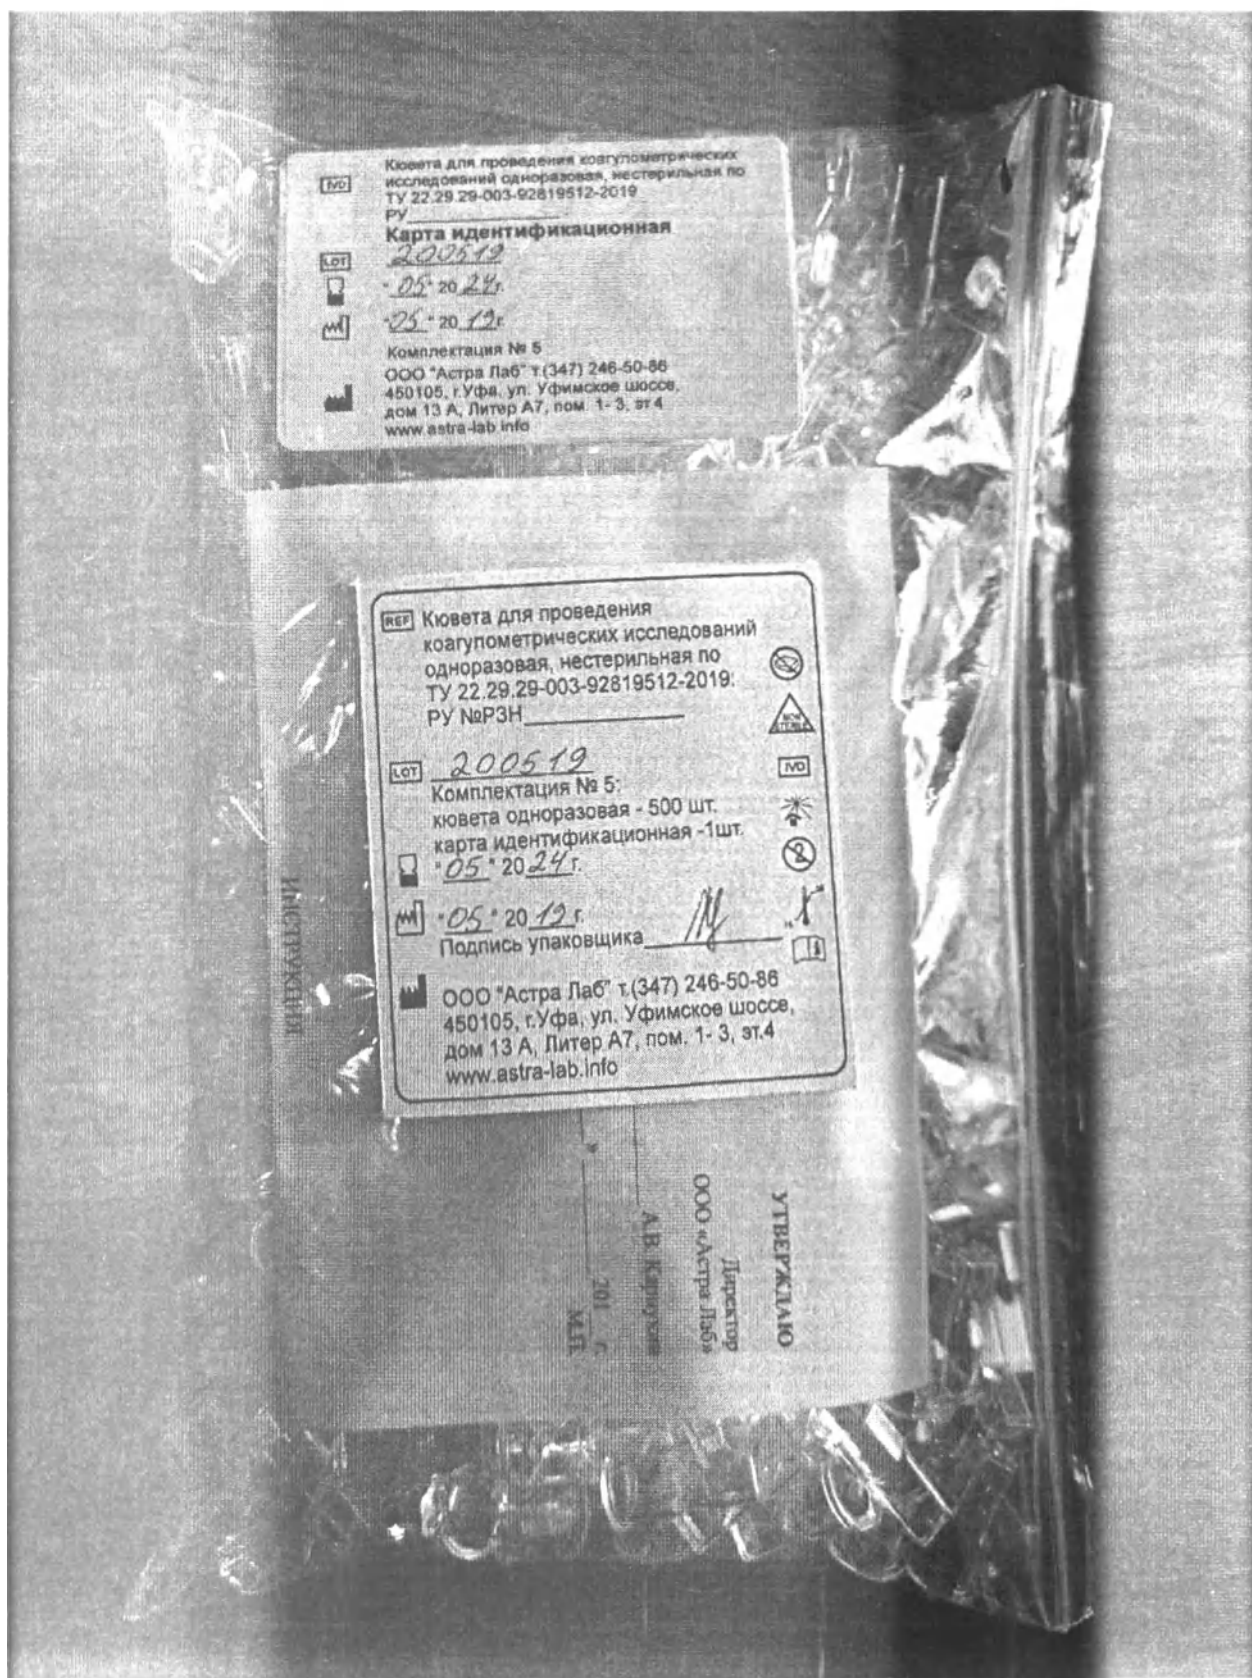


Рисунок 1. Графическое изображение медицинского изделия - Кювета для проведения коагулометрических исследований, одноразовая, нестерильная по ТУ 22.29.29-003-92819512-2019 в варианте комплектации «5».

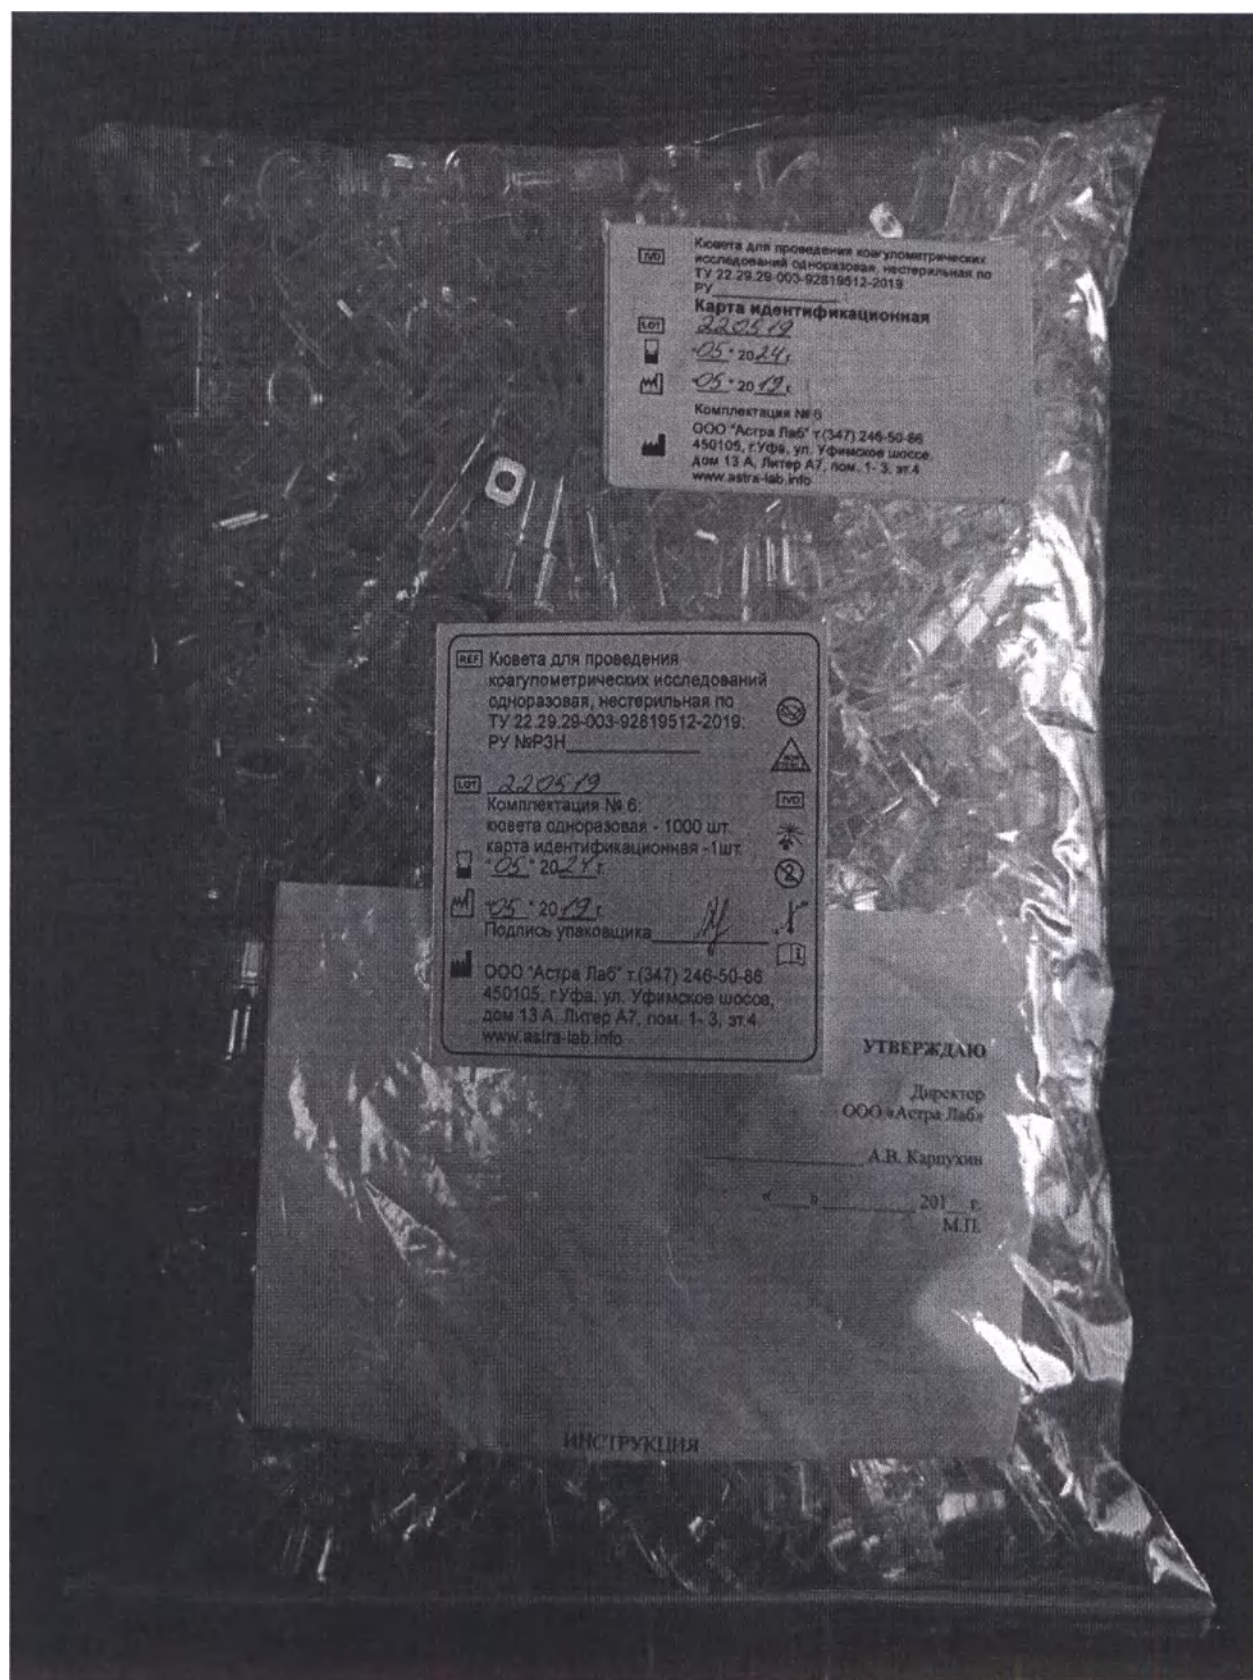


Рис 6. Фотографическое изображение медицинского изделия - Кювета для проведения коагулометрических исследований, одноразовая, нестерильная по ТУ 22.29.29-003-92819512-2019 в варианте комплектации «6».

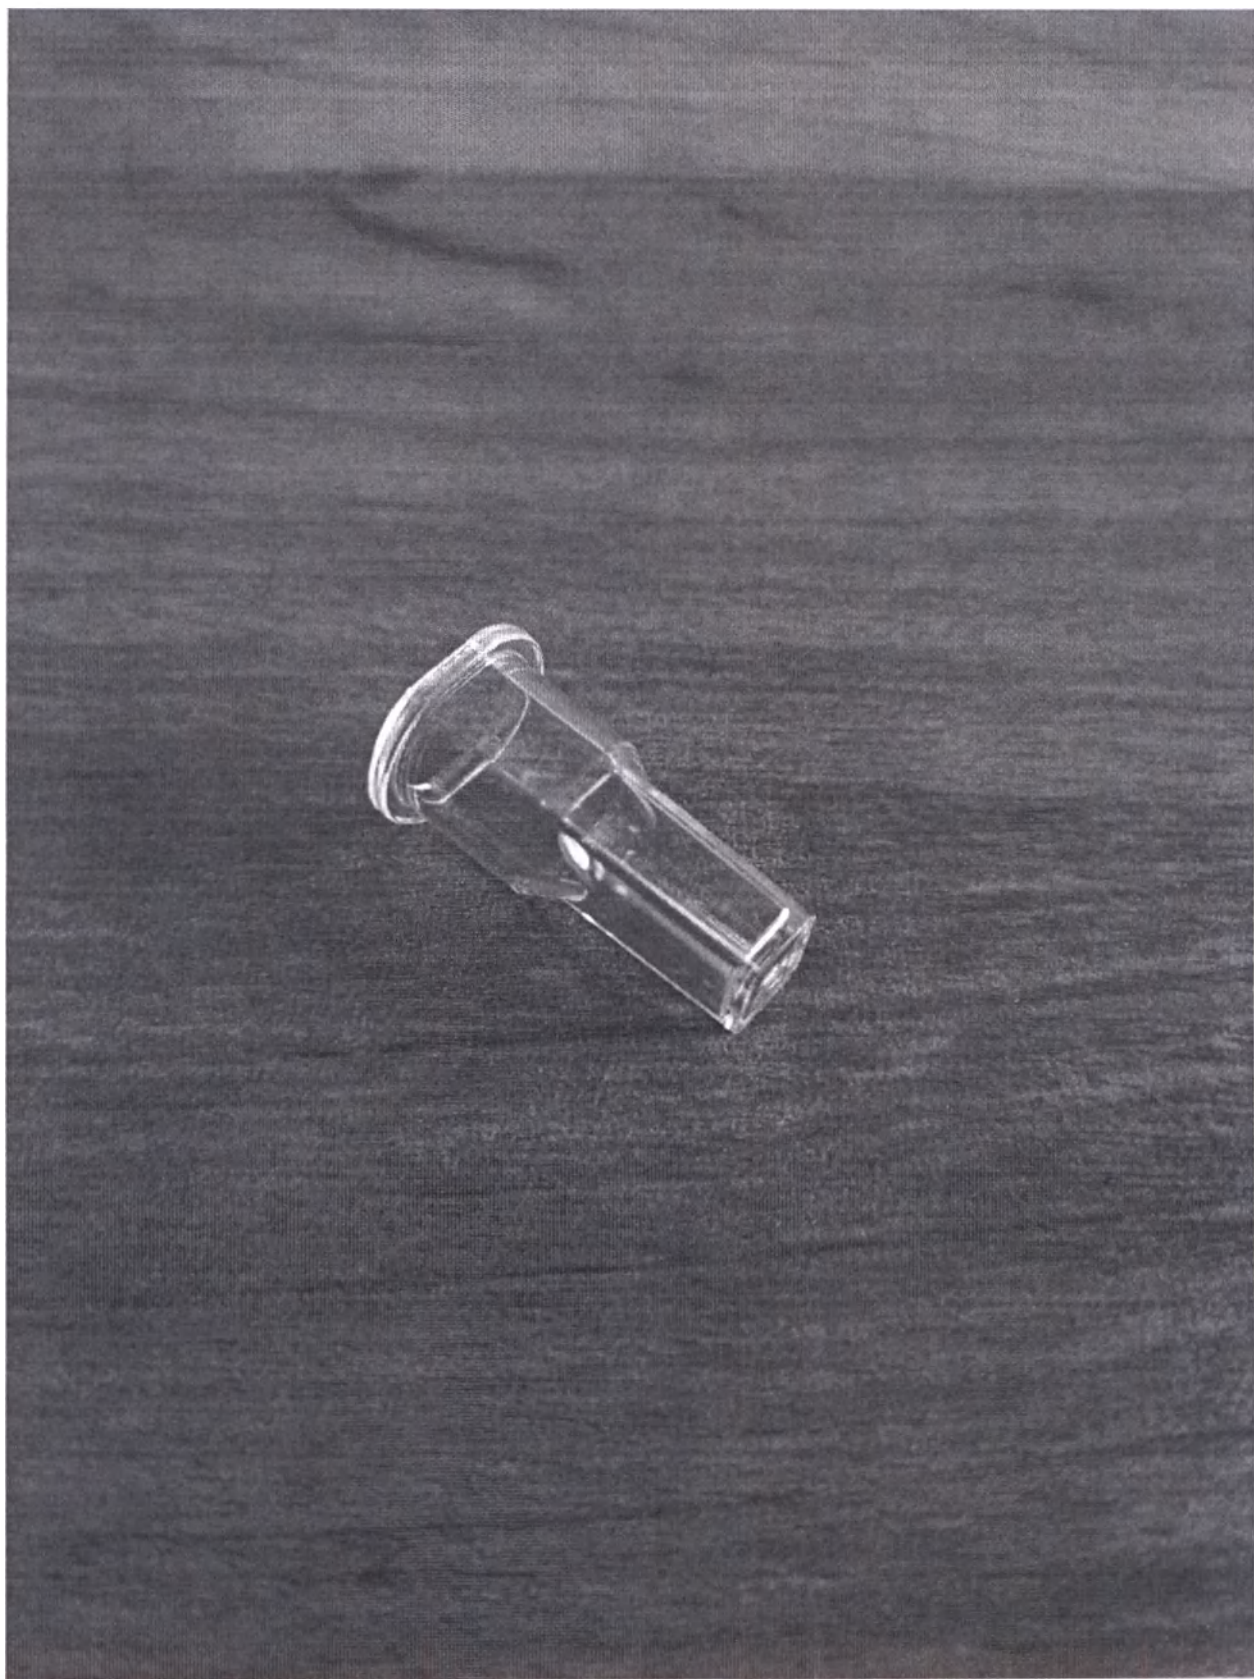


Рис 7. Кювета для проведения коагулометрических исследований, одноразовая, нестерильная.

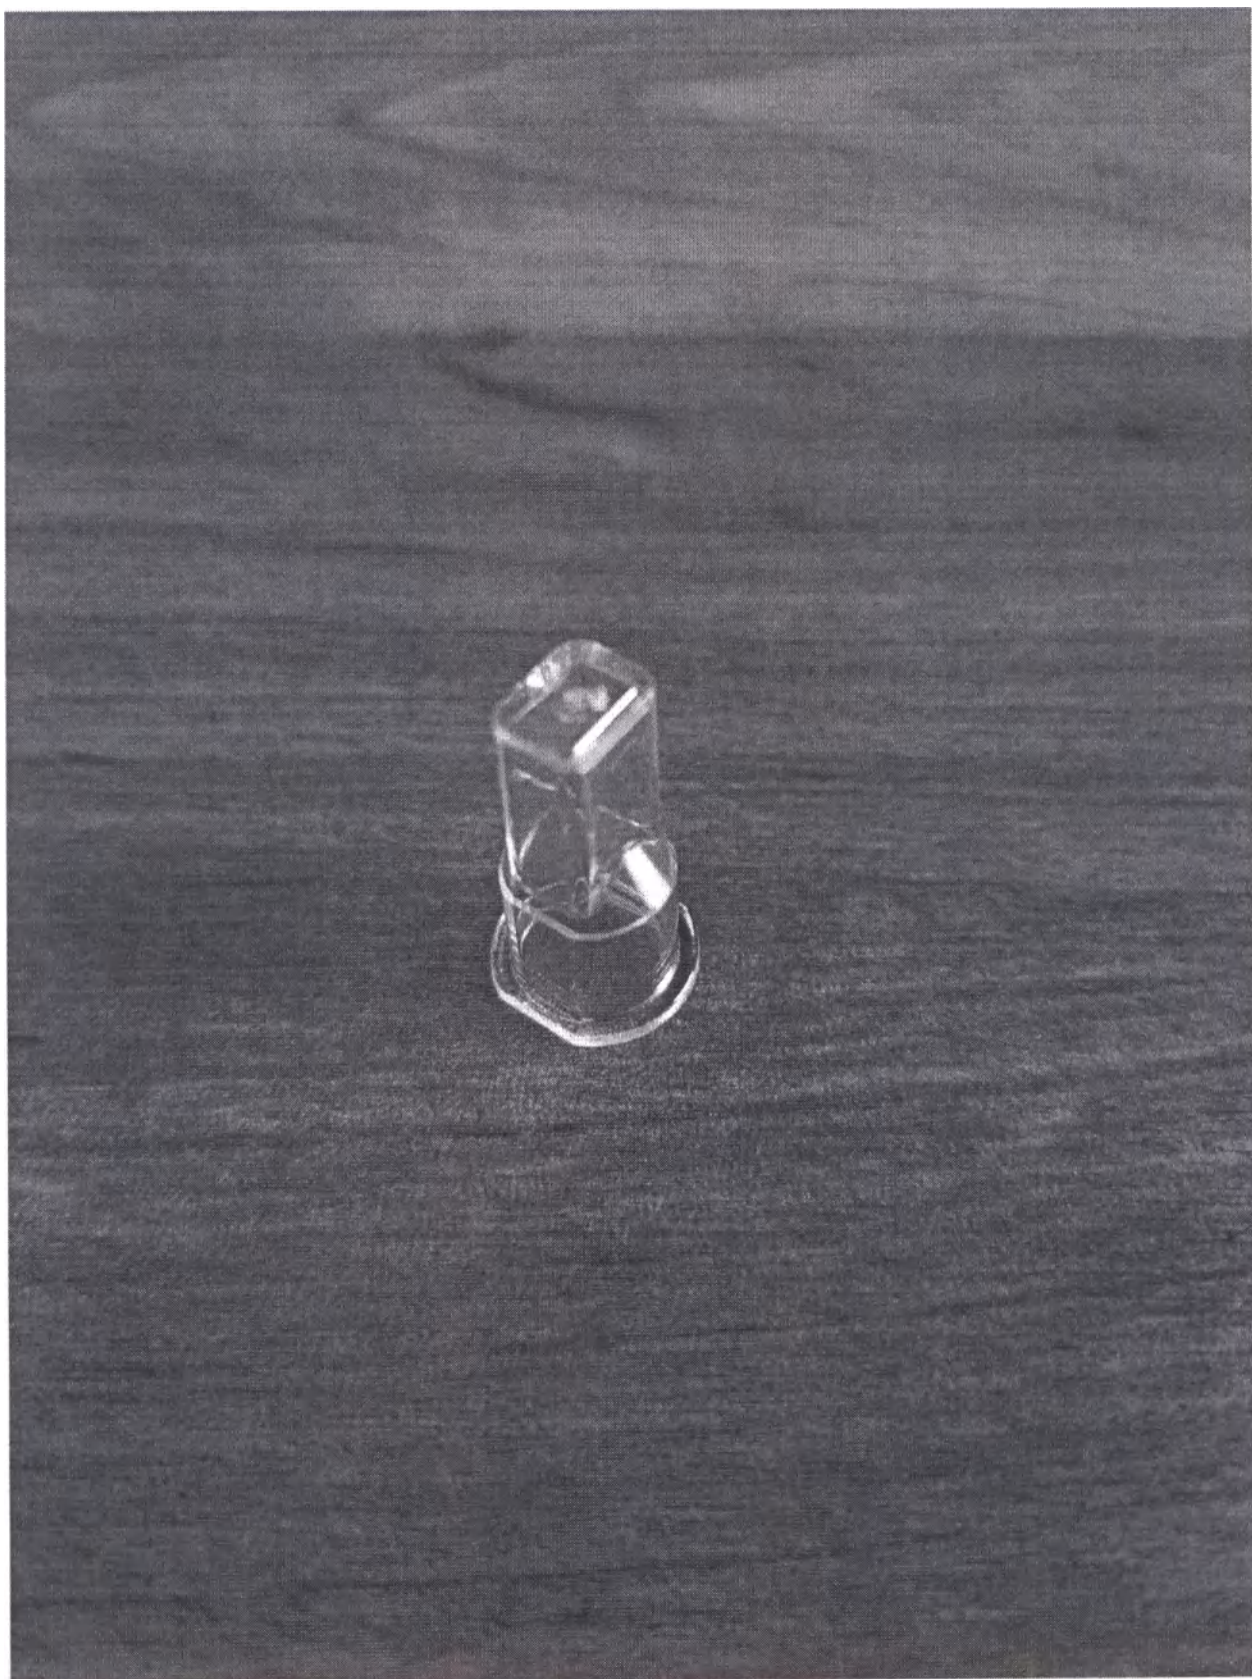


Рис 8. Кювета для проведения коагулометрических исследований, одноразовая, нестерильная.



Рис 9. Карта идентификационная.

10 (десять) листов
Директор ООО «Астра Лаб»
Карпухин А.В.

