

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.


М.П.




Фотографические изображения общего вида


Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614693-2022

2023 - 7

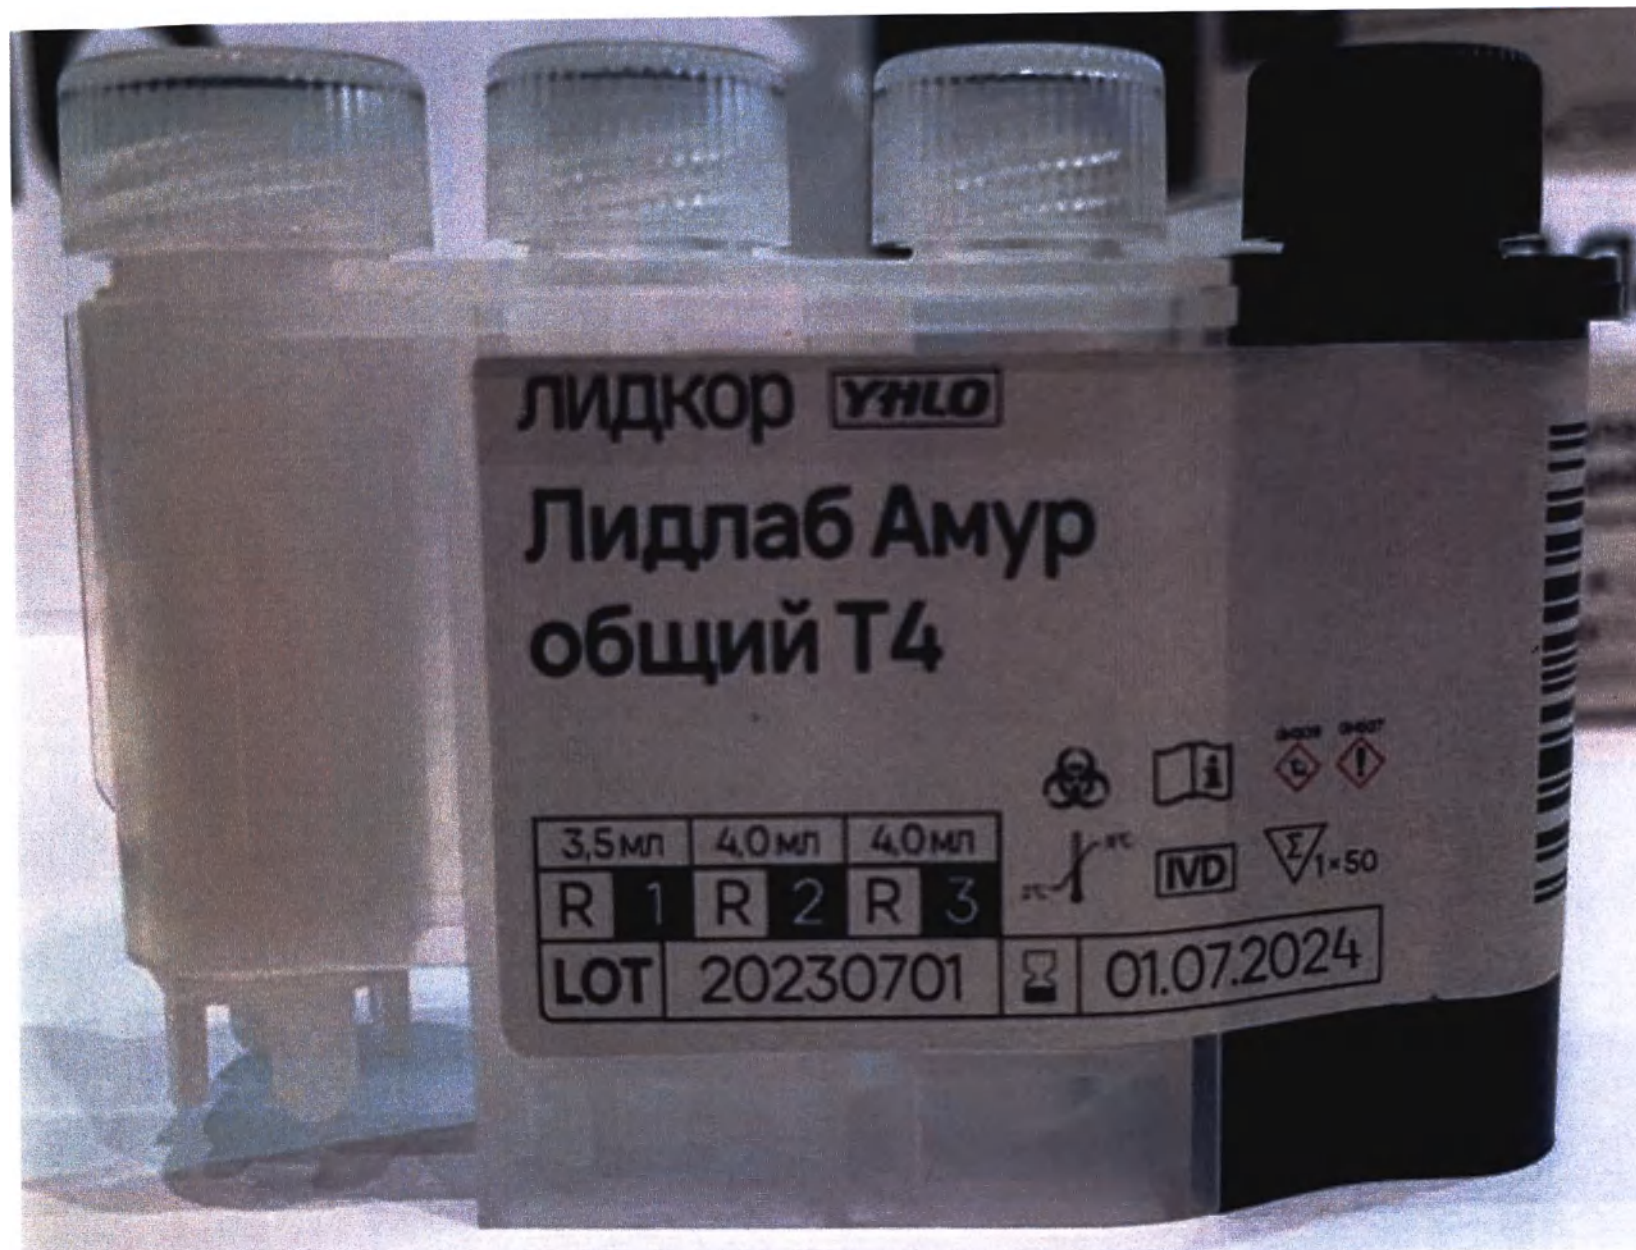

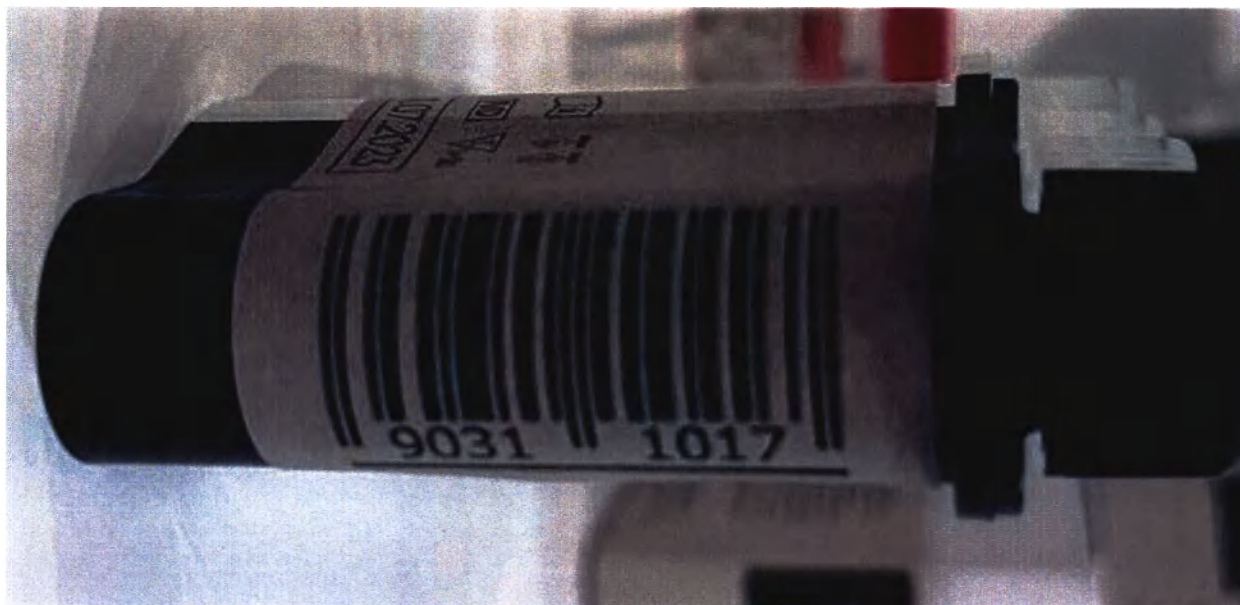




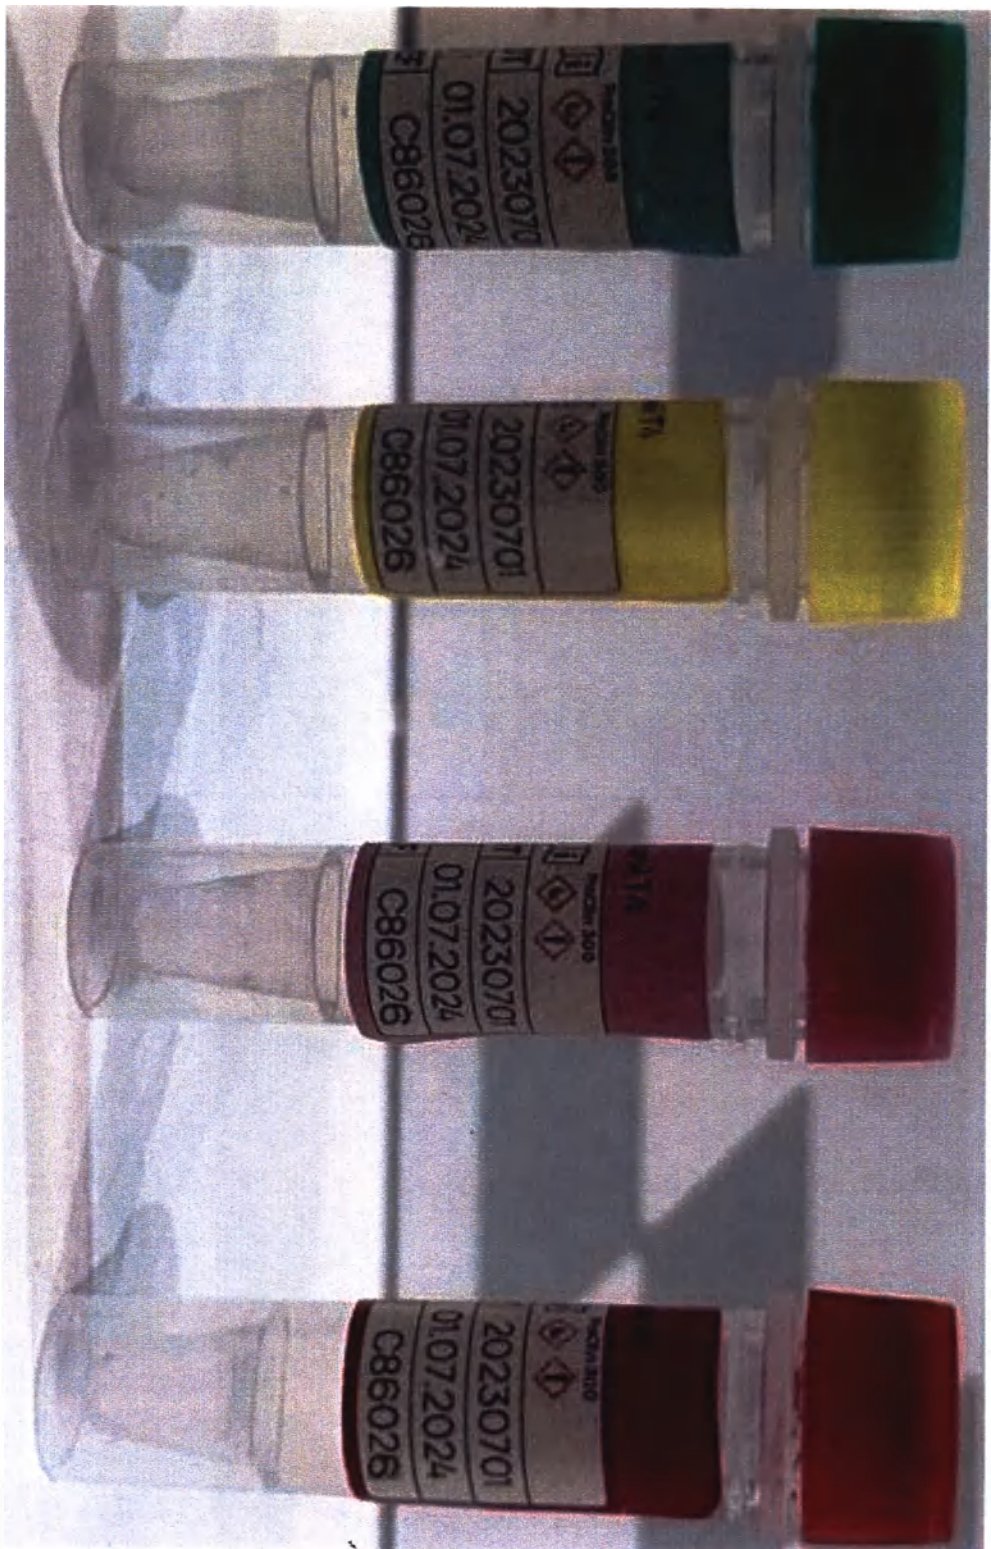

лидкор
Лидлаб Амур
общий Т4


Пароизоляционные
крышки - 4 шт.

LOT 20230701



01.07.2024


REF C86026



лидкор
Лидлаб Амур
общий Т4


Пароизоляционные
крышки - 4 шт.

LOT 20230701



01.07.2024

REF C86026



лидлаб

лидкор





Лидлаб Амур общий Т4

Набор реагентов на 100 тестов

YNLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для обработки образцов (R3), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.



01.07.2023

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86026



лидкор

Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

лидлаб




лидкор



Лидлаб Амур общий Т4

Набор реагентов на 200 тестов

YNLO



ProClin 300

01.07.2023

LOT	20230701	01.07.2024	REF	C86026
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для обработки образцов (R3), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.



лидкор

Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР»



620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для
количественного определения общего тироксина
(общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65814693-
2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

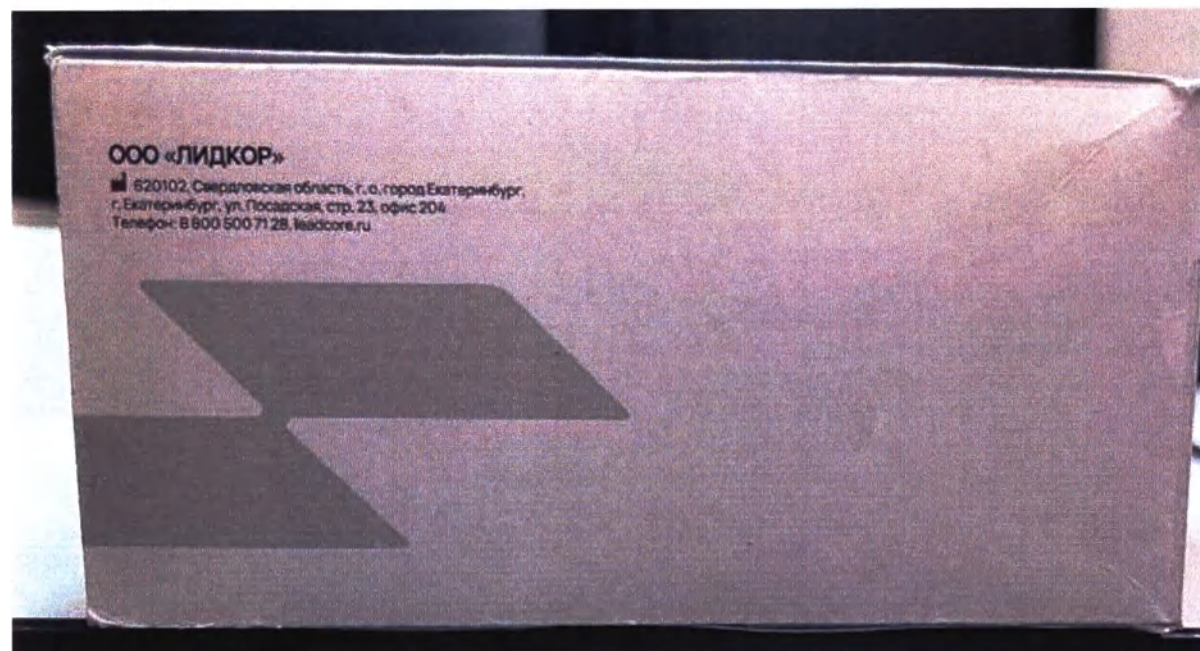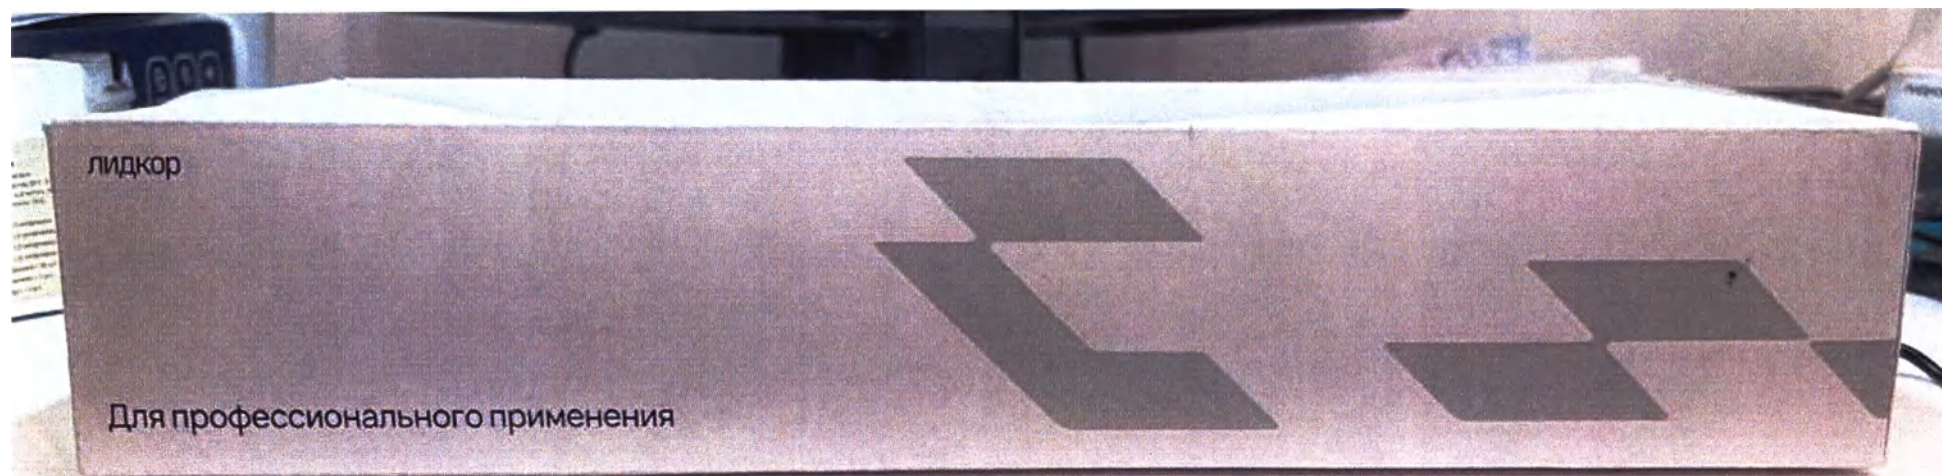

Лидраб



Лидраб Амур
общий Т4

Набор документов на 1000 страниц

УНКО

Состав изданий

1. Издание: 1-е издание, 2014 г.
2. Издание: 2-е издание, 2015 г.
3. Издание: 3-е издание, 2016 г.
4. Издание: 4-е издание, 2017 г.
5. Издание: 5-е издание, 2018 г.
6. Издание: 6-е издание, 2019 г.
7. Издание: 7-е издание, 2020 г.
8. Издание: 8-е издание, 2021 г.
9. Издание: 9-е издание, 2022 г.
10. Издание: 10-е издание, 2023 г.

1000 страниц
1000 страниц
1000 страниц
1000 страниц
1000 страниц
1000 страниц
1000 страниц
1000 страниц
1000 страниц
1000 страниц


Внимание! Данное издание является частью комплекта документов, необходимых для проведения работ по проектированию и строительству объектов капитального строительства. Данное издание не является самостоятельным документом и не может использоваться отдельно от остальных документов комплекта.

ООО «ЛИДКОР»


620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru





лидкор

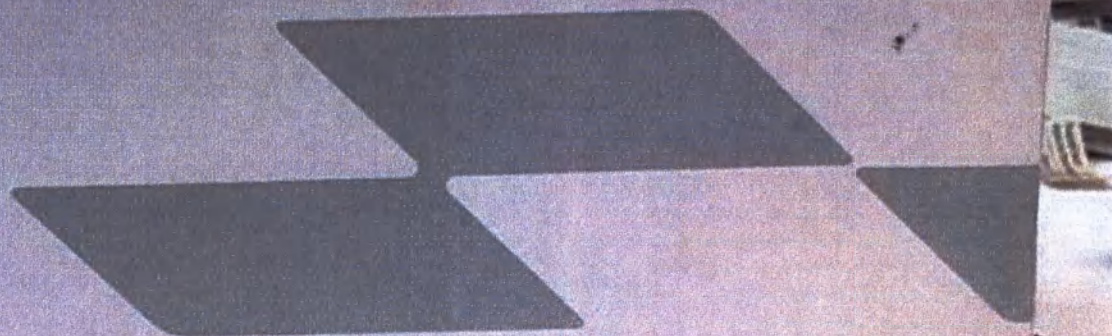

Для профессионального
применения

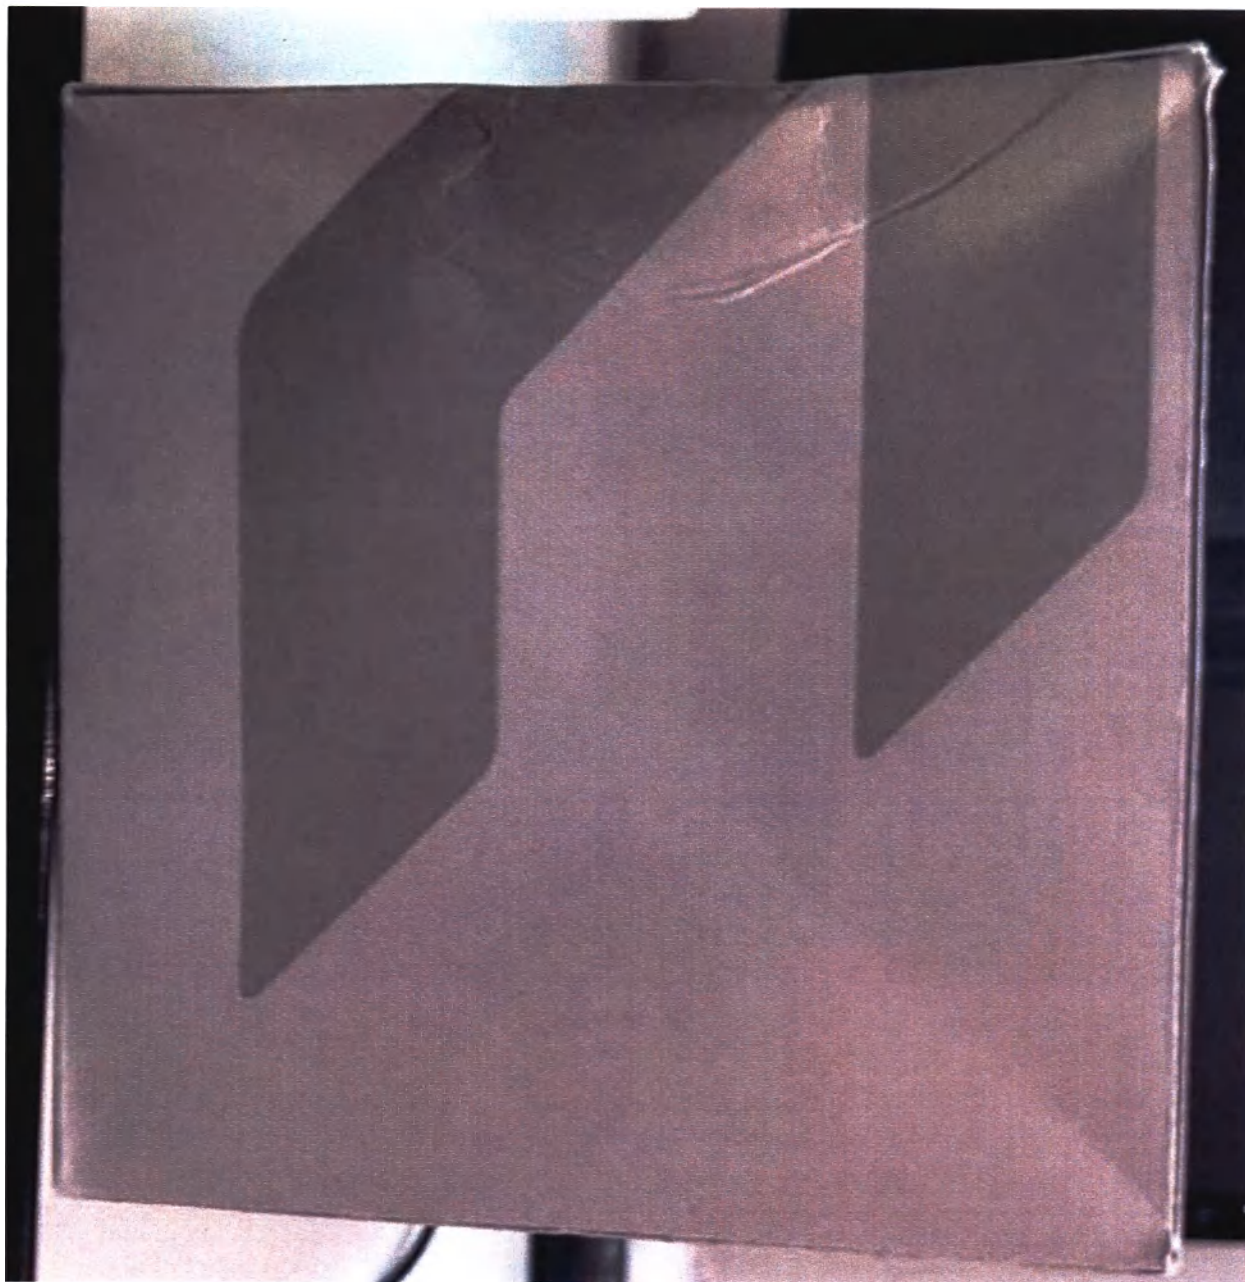

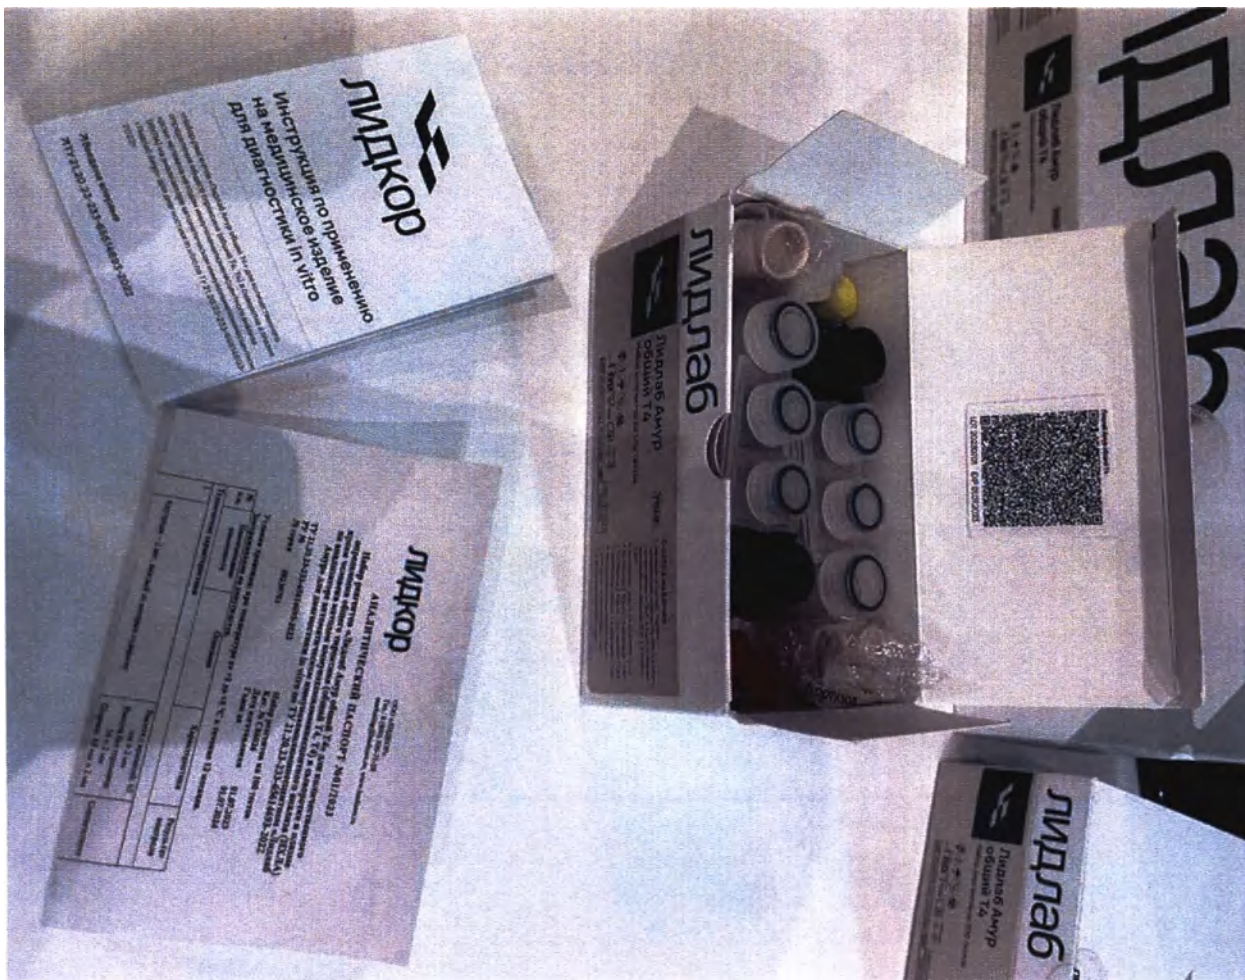

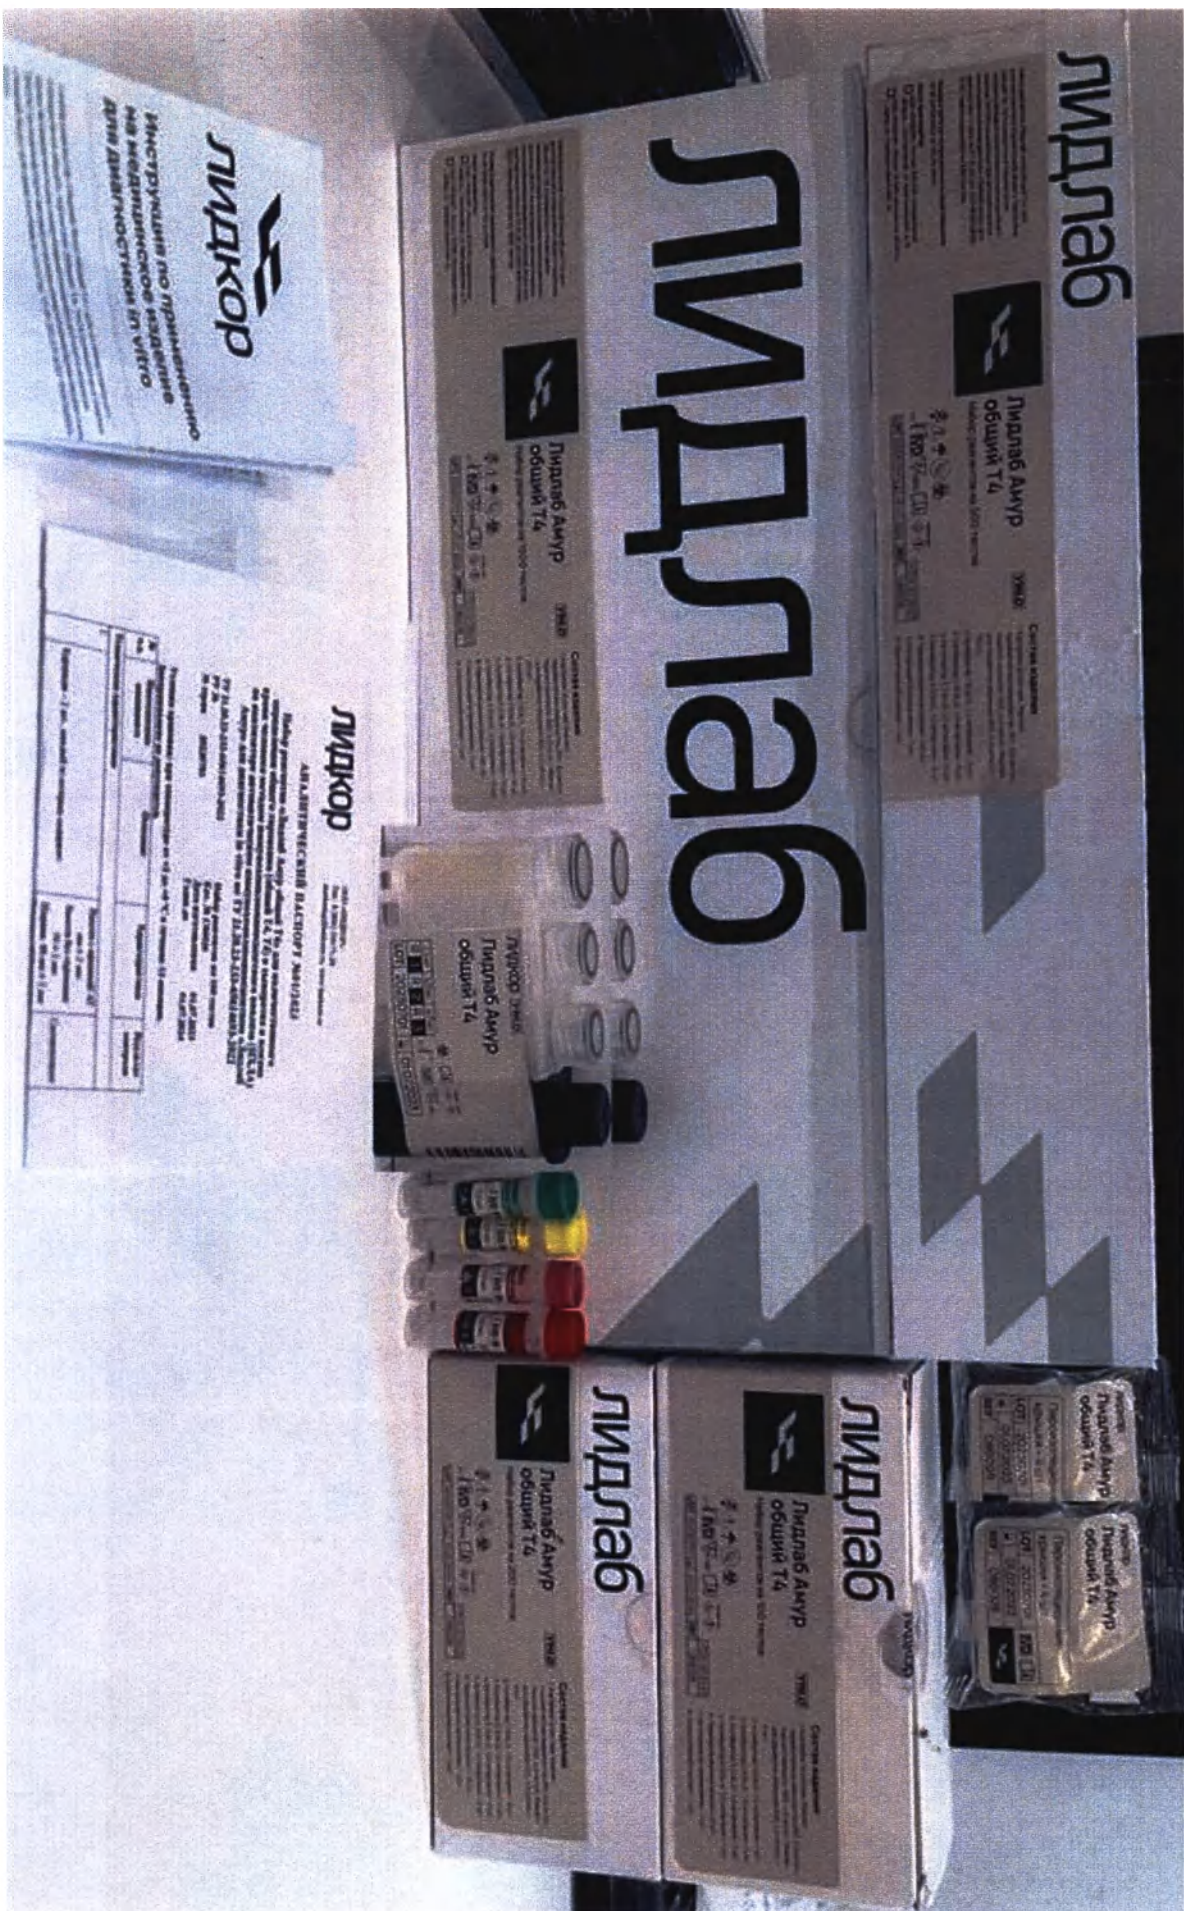



Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614693-2022




Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023	
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86026



Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614693-2022


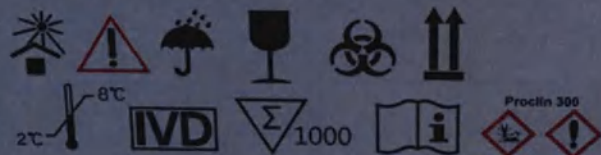


Для профессионального применения

ООО «ЛИДЛАБ», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.			01.07.2023
LOT	20230701	01.07.2024	REF C86026



Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-233-65614693-2022




Proclin 300

Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.б. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023	
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86026



Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614693-2022



IVD

Σ 200



Proclin 300



Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.б. город Екатеринбург, г. Екатеринбург; ул. Посадский, стр. 23, офис 204.		01.07.2023	
LOT	20230701	01.07.2024	REF C86026

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
26 (двадцать шесть) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут
«01» июля 2023 г.
М.П. .



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614693-2022

2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилуминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилуминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614.693-2022 Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «Лидкор», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодурская, д. 15
☐ ООО «Лидкор», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленности, 3а

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилуминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилуминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614.693-2022 Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «Лидкор», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодурская, д. 15
☐ ООО «Лидкор», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленности, 3а



Лидлаб Амур общий Т4


Набор реагентов на 100 тестов



Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент параналитических микрочастиц (R1), 3,5 мл/шт.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/шт.; Реагент для обработки образцов (R3), 4,0 мл/шт.) - 2 шт.;

2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон - 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон - 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон - 1 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон - 1 шт.;
6. Пароксизольонные крышки - 8 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;
8. Аналитический паспорт - 1 шт.



LOT 20230701 01.07.2024 REF C86026



Лидлаб Амур общий Т4

Набор реагентов на 200 тестов



Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент параналитических микрочастиц (R1), 3,5 мл/шт.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/шт.; Реагент для обработки образцов (R3), 4,0 мл/шт.) - 4 шт.;

2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон - 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон - 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон - 2 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон - 2 шт.;
6. Пароксизольонные крышки - 16 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;
8. Аналитический паспорт - 1 шт.



LOT 20230701 01.07.2024 REF C86026

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т₄) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614.693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «Лидлаб», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «Лидлаб», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур общий Т4

Набор реагентов на 500 тестов

YUNLO



LOT 20230701 01.07.2024 REF C86026

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент паразитных микроорганизмов (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для обработки образцов (R3), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 5 шт.
6. Пароксизмальные крышки – 40 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт.
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т₄) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614.693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «Лидлаб», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «Лидлаб», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур общий Т4

Набор реагентов на 1000 тестов

YUNLO



LOT 20230701 01.07.2024 REF C86026

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент паразитных микроорганизмов (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для обработки образцов (R3), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
6. Пароксизмальные крышки – 80 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт.
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

Лидлаб Амур
общий Т4



3,5мл	4,0мл	4,0мл
R 1	R 2	R 3
LOT		20220801

2°C 8°C IVD $\Sigma 1 \times 50$

01.07.2023

лидкор

Лидлаб Амур общий Т4

2°C 8°C IVD

1,0 мл	LOT	20220801
		01.07.2023
CAL 1	REF	C86026

лидкор

Лидлаб Амур общий Т4

2°C 8°C IVD

1,0 мл	LOT	20220801
		01.07.2023
CAL 2	REF	C86026

лидкор
Лидлаб Амур общий Т4

     		
1,0 мл	LOT	20220801
		01.07.2023
CAL 3	REF	C86026

лидкор
Лидлаб Амур общий Т4

     		
1,0 мл	LOT	20220801
		01.07.2023
CAL 4	REF	C86026

лидкор
Лидлаб Амур
общий Т4


Пароизоляционные крышки – 4 шт.		
LOT	20220801	 
	01.07.2023	
REF	C86026	




Лидлаб Амур обирей Т4



LOT 20220801 EXP 01.07.2023

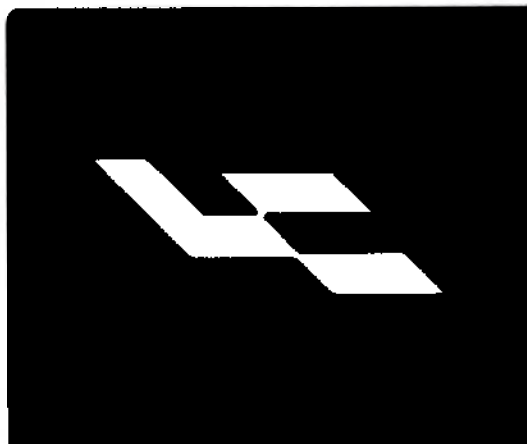


Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614693-2022

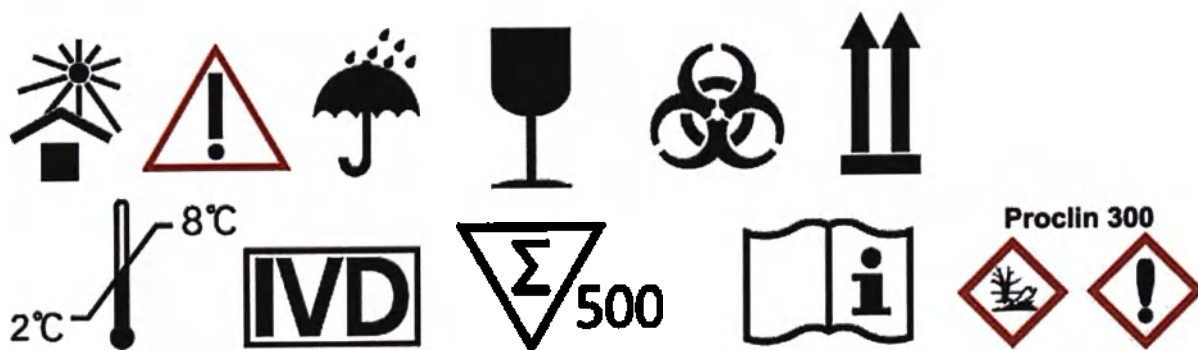


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86026

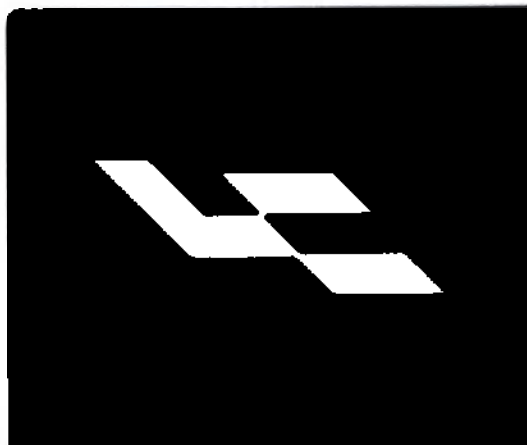


Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614693-2022

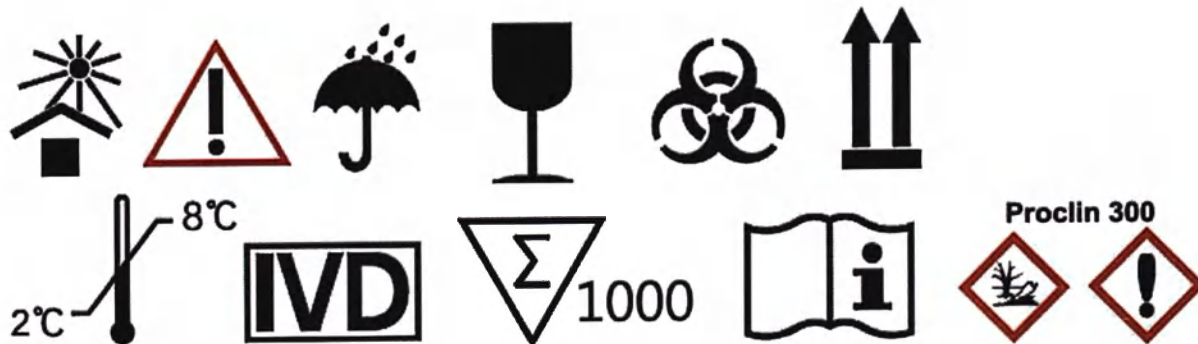


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86026

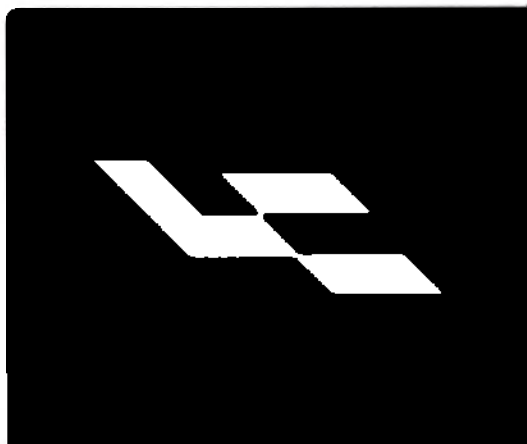


Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614693-2022

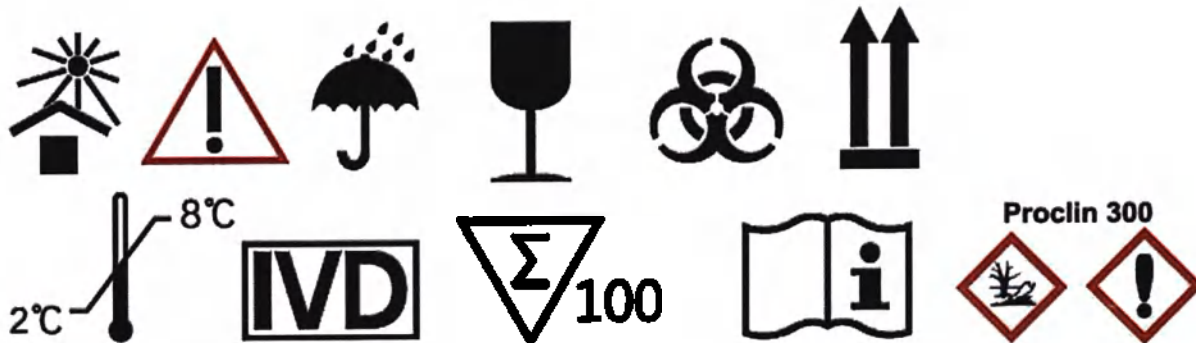


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86026

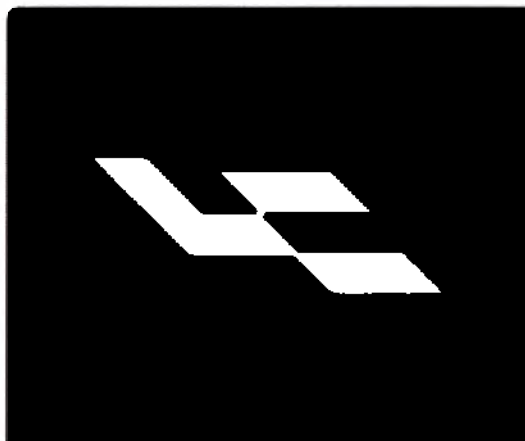


Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т4» для количественного определения общего тироксина (общий Т4, Т4) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-233-65614693-2022

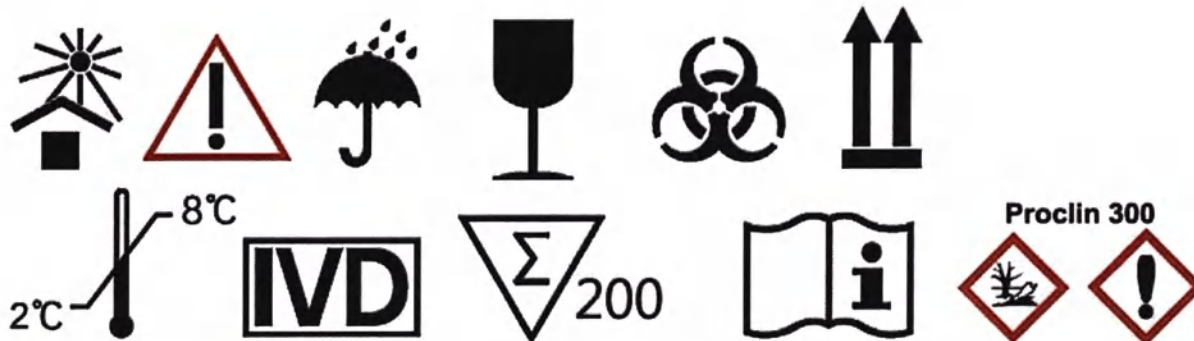


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86026	

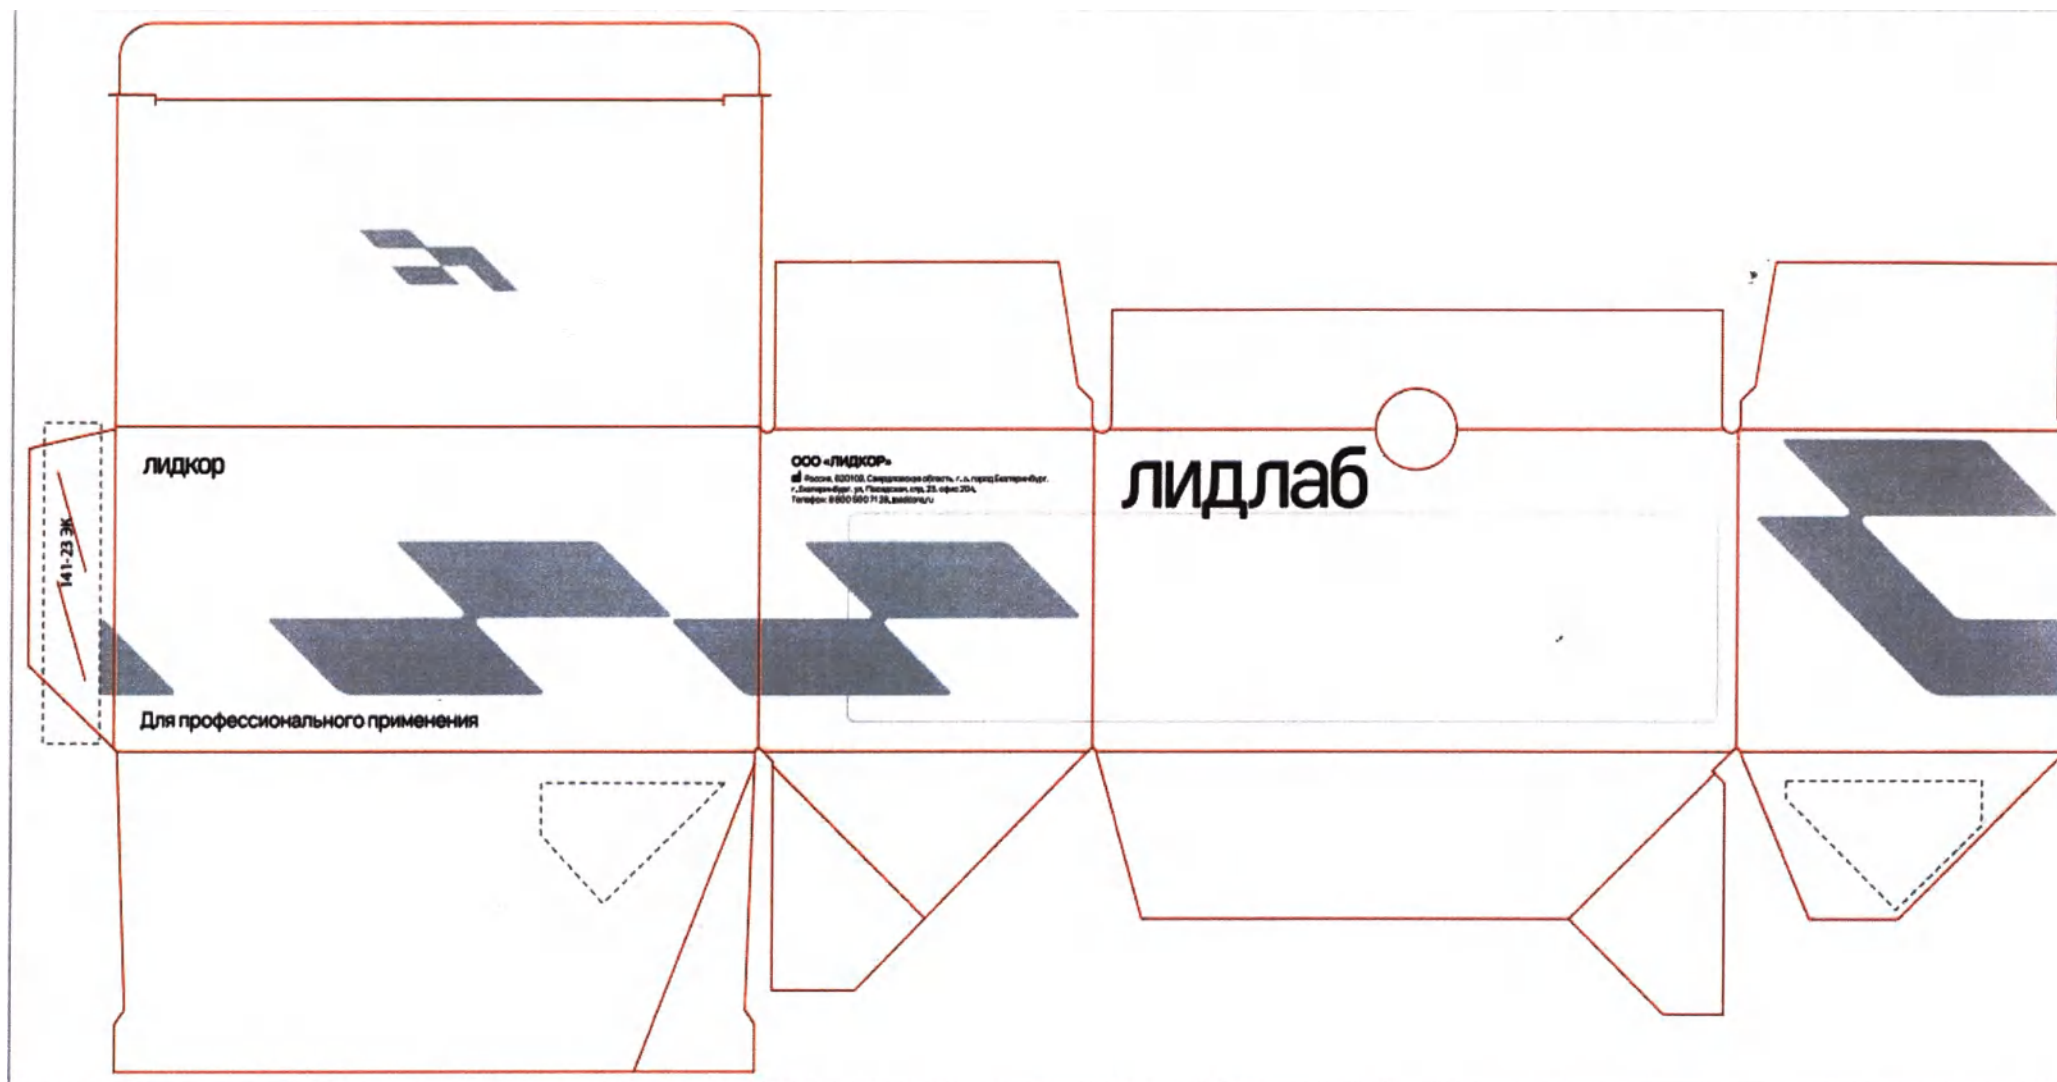

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
12 (двенадцать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»
 /Е. Ю. Гохгут/

