РАЗРАБОТКА МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ООО «Астра Лаб»

Россия, 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа,
улица Уфимское шоссе, д. № 13 А, литер А7, помещения 1-3, эт.4
(347) 246-50-86 многоканальный
e-mail: astra@astra-lab.info

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Астра Лаб»
_____ А.В. Карпухин
«14» _____ 2021 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия «Анализатор автоматический скорости оседания эритроцитов АСТРА-100 по ТУ 26.60.12-004-92819512-2020».

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

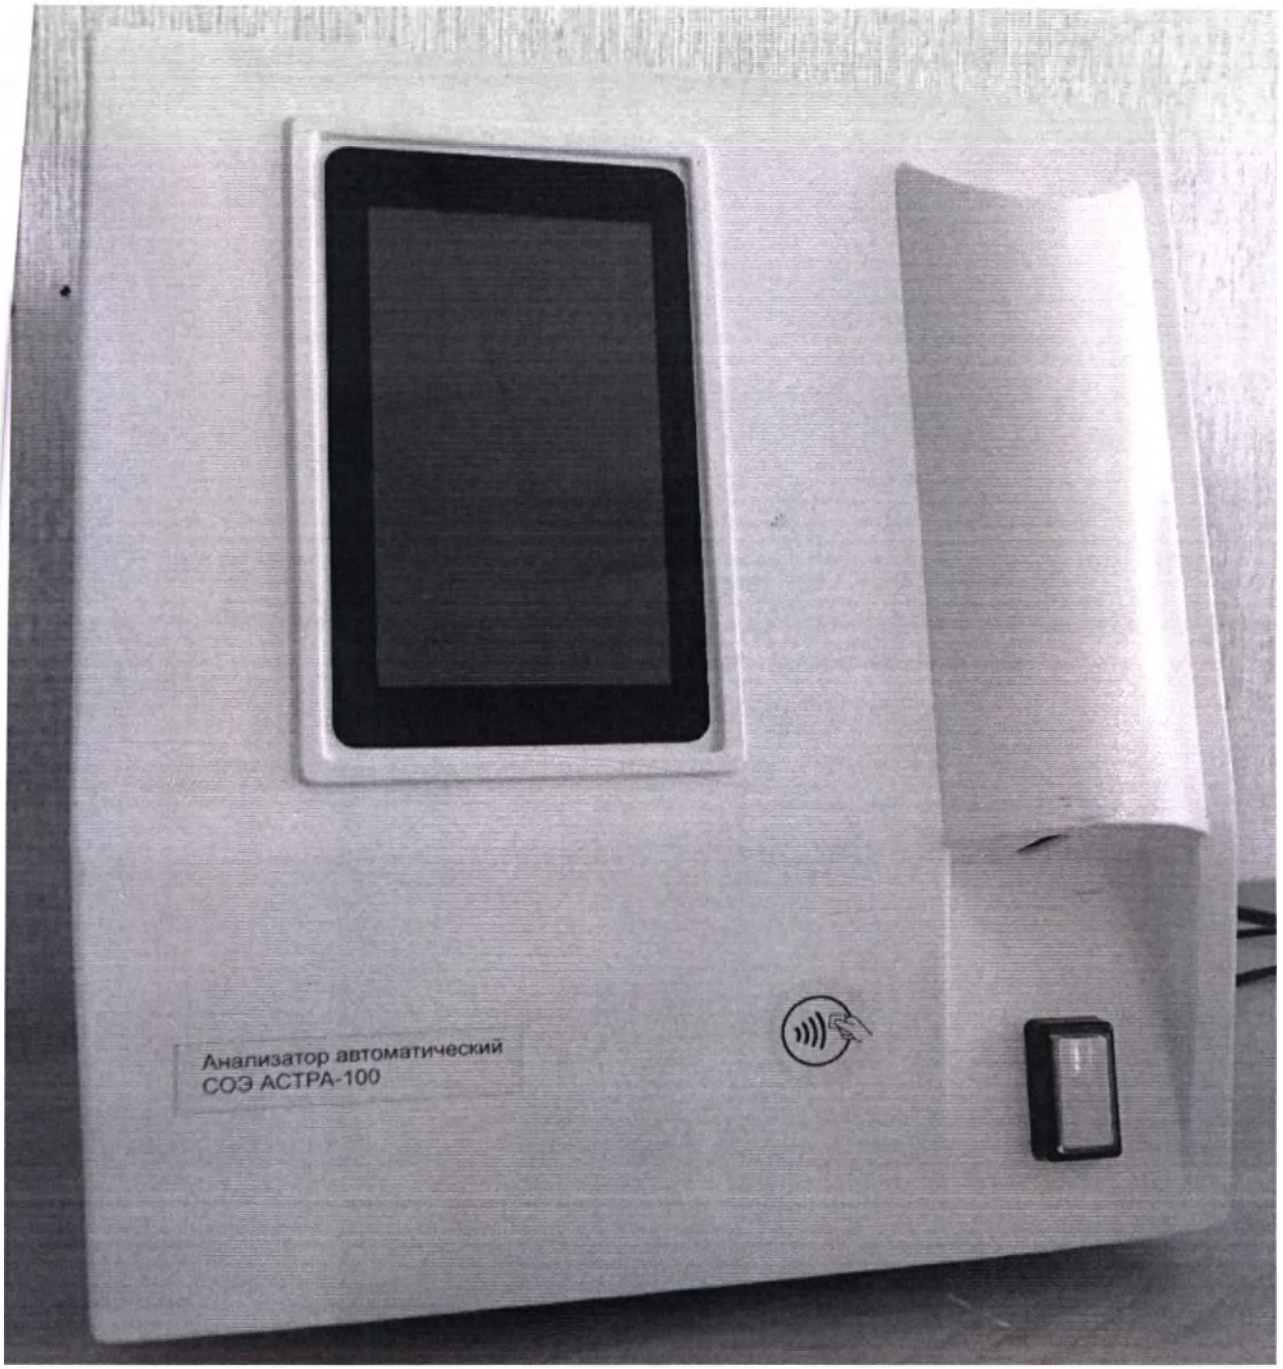

Рисунок 1. Блок анализатора вид спереди.

Рисунок 2 – Карта идентификационная.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

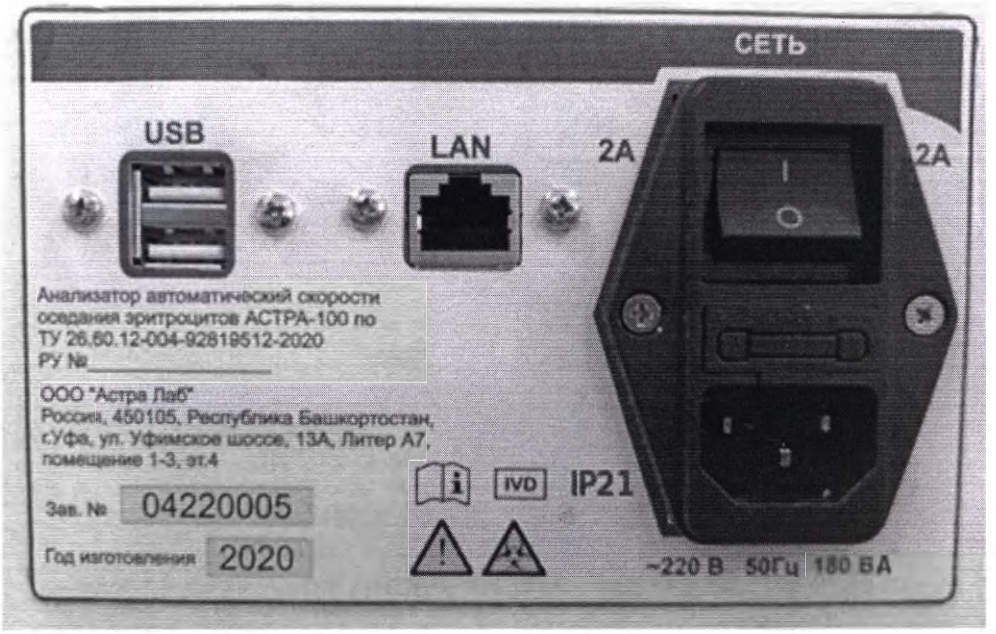

Рисунок 3. Блок анализатора, задняя панель.

Рисунок 4. Консоль подключения трубки для промывающего раствора и трубки для слива отходов на задней части блока анализатора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

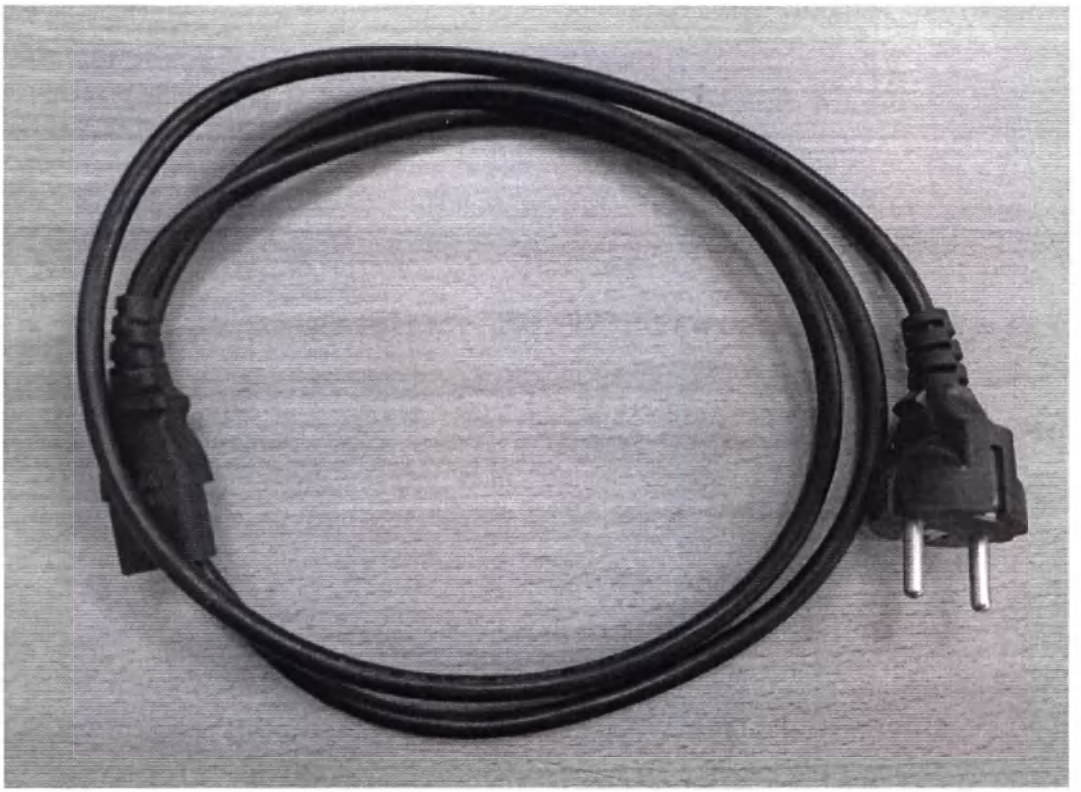

Рисунок 5. – Кабель питания.

Рисунок 6. Трубка для промывавшего раствора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 7. – Трубка для слива отходов.

Рисунок 8. – Канистра для слива отходов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

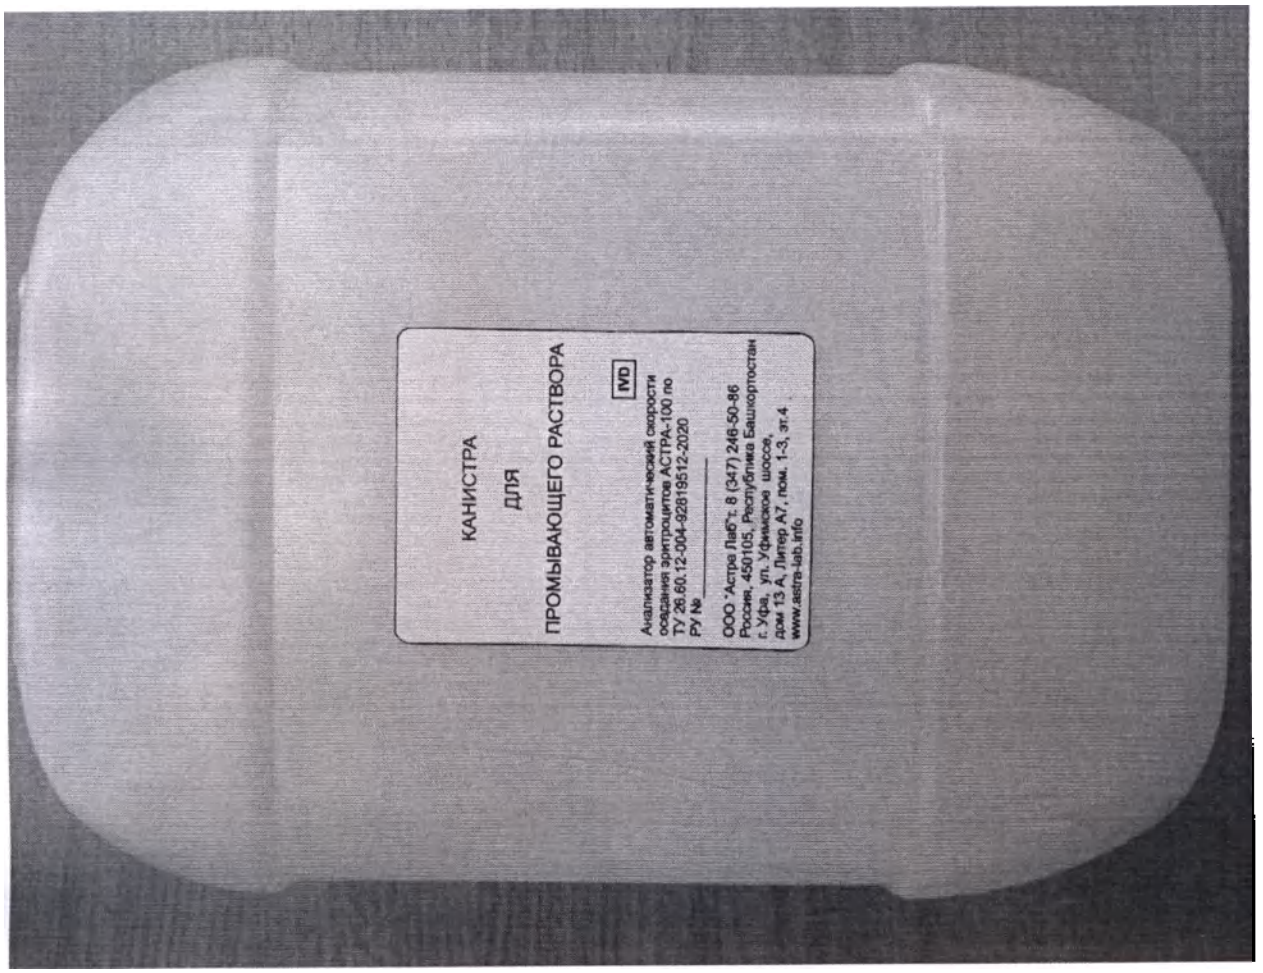

Рисунок 9. – Канистра для промывающего раствора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито и пронумеровано
6 (шесть) листов
Директор ООО «Астра Лаб»
_____ Карпухин А.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU