


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный Директор
ООО "СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

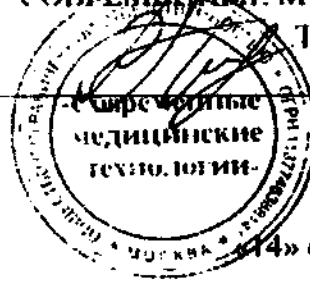

Петлина Р.И.

«14» февраля 2023 г.

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия:**

«Катетер радиочастотной абляции сердца HAGMED EA»

Производства:

**HAGMED SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA
KOMANDYTOWA (Польша)**

Ablation electrode
Elektroda ablacyjna

REF

EA6QX141U4I8AT

Size
Rozmiar

6F

Number of poles:
Ilość pierścieni:

Quadrapolar

Spacing of poles:
Rozstaw pierścieni:

1-4-1

Type of steerability
Typ sterowalności:

Unidirectional
Jednokierunkowa

Size of curve:
Wielkość zagięcia:


X

Type of ablation tip:
Typ głowicy ablacyjnej:

Irrigated, 8 mm
Irygowana, 8 mm

Insertion length:
Długość robocza:

115 cm



(01)05900672697001(17)220731(10)20200813

STERILE R



45°C



CE 1434



LOT 20200813

MADE IN POLAND



5 900672 697001

2022-07



HAGMED Sp. z o.o. 50-100
50-200 Raków Mazowiecki ul. Tomaszowska 32
POLAND
Tel. +48 46 614 44 39 Fax +48 46 614 48 05
e-mail: info@hagmed.com www.hagmed.com



Ablation electrode Elektroda ablacyjna

REF


EA6QX162U8AT

Size: Rozmiar:	6F	Number of poles: Ilość pierścieni:	Quadrapolar
Size of curve: Wielkość zagięcia:			X
Spacing of poles: Rozstaw pierścieni:			1-6-2
Type of steerability: Typ sterowalności:			Unidirectional Jednokierunkowa
Type of ablation tip: Typ głowicy ablacyjnej:			Non-Irrigated, 8 mm Nieirygowana, 8 mm
Insertion length: Długość robocza:			115 cm







(01)05900672697018(17)220731(0)20200806

STERILE R



LOT 20200806



2022-07

CE 1434

MADE IN POLAND

HAGMED Sp. z o.o. sp. k.
PL 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32
POLAND
Tel: +48 46 814 44 29 Fax: +48 46 814 48 05
e-mail: info@hagmed.com www.hagmed.com



5 900672 697018

Ablation electrode
Elektroda ablacyjna

REF EA6QX162U8AT

LOT 20200806



(01)05900672697018(17)220731(10)20200806



Ablation electrode
Elektroda ablacyjna

REF EA6QX162U8AT


LOT 20200806





(01)05900672697018(17)220731(10)20200806




1- Катетер радиочастотной абляции сердца HAGMED FA с направлением без ирригации тип
 «В»/ «S»/ «M»/ «L»/ «X» расположение электродов 1-6-2 / 1-4-1 / 2-5-2 / 2-2-
 размер 61 / 31 / 81 голевой электрод 3,5/4/8 мм. (Потребительская упаковка. Индивидуальная упаковка.
 Общий вид изделия)

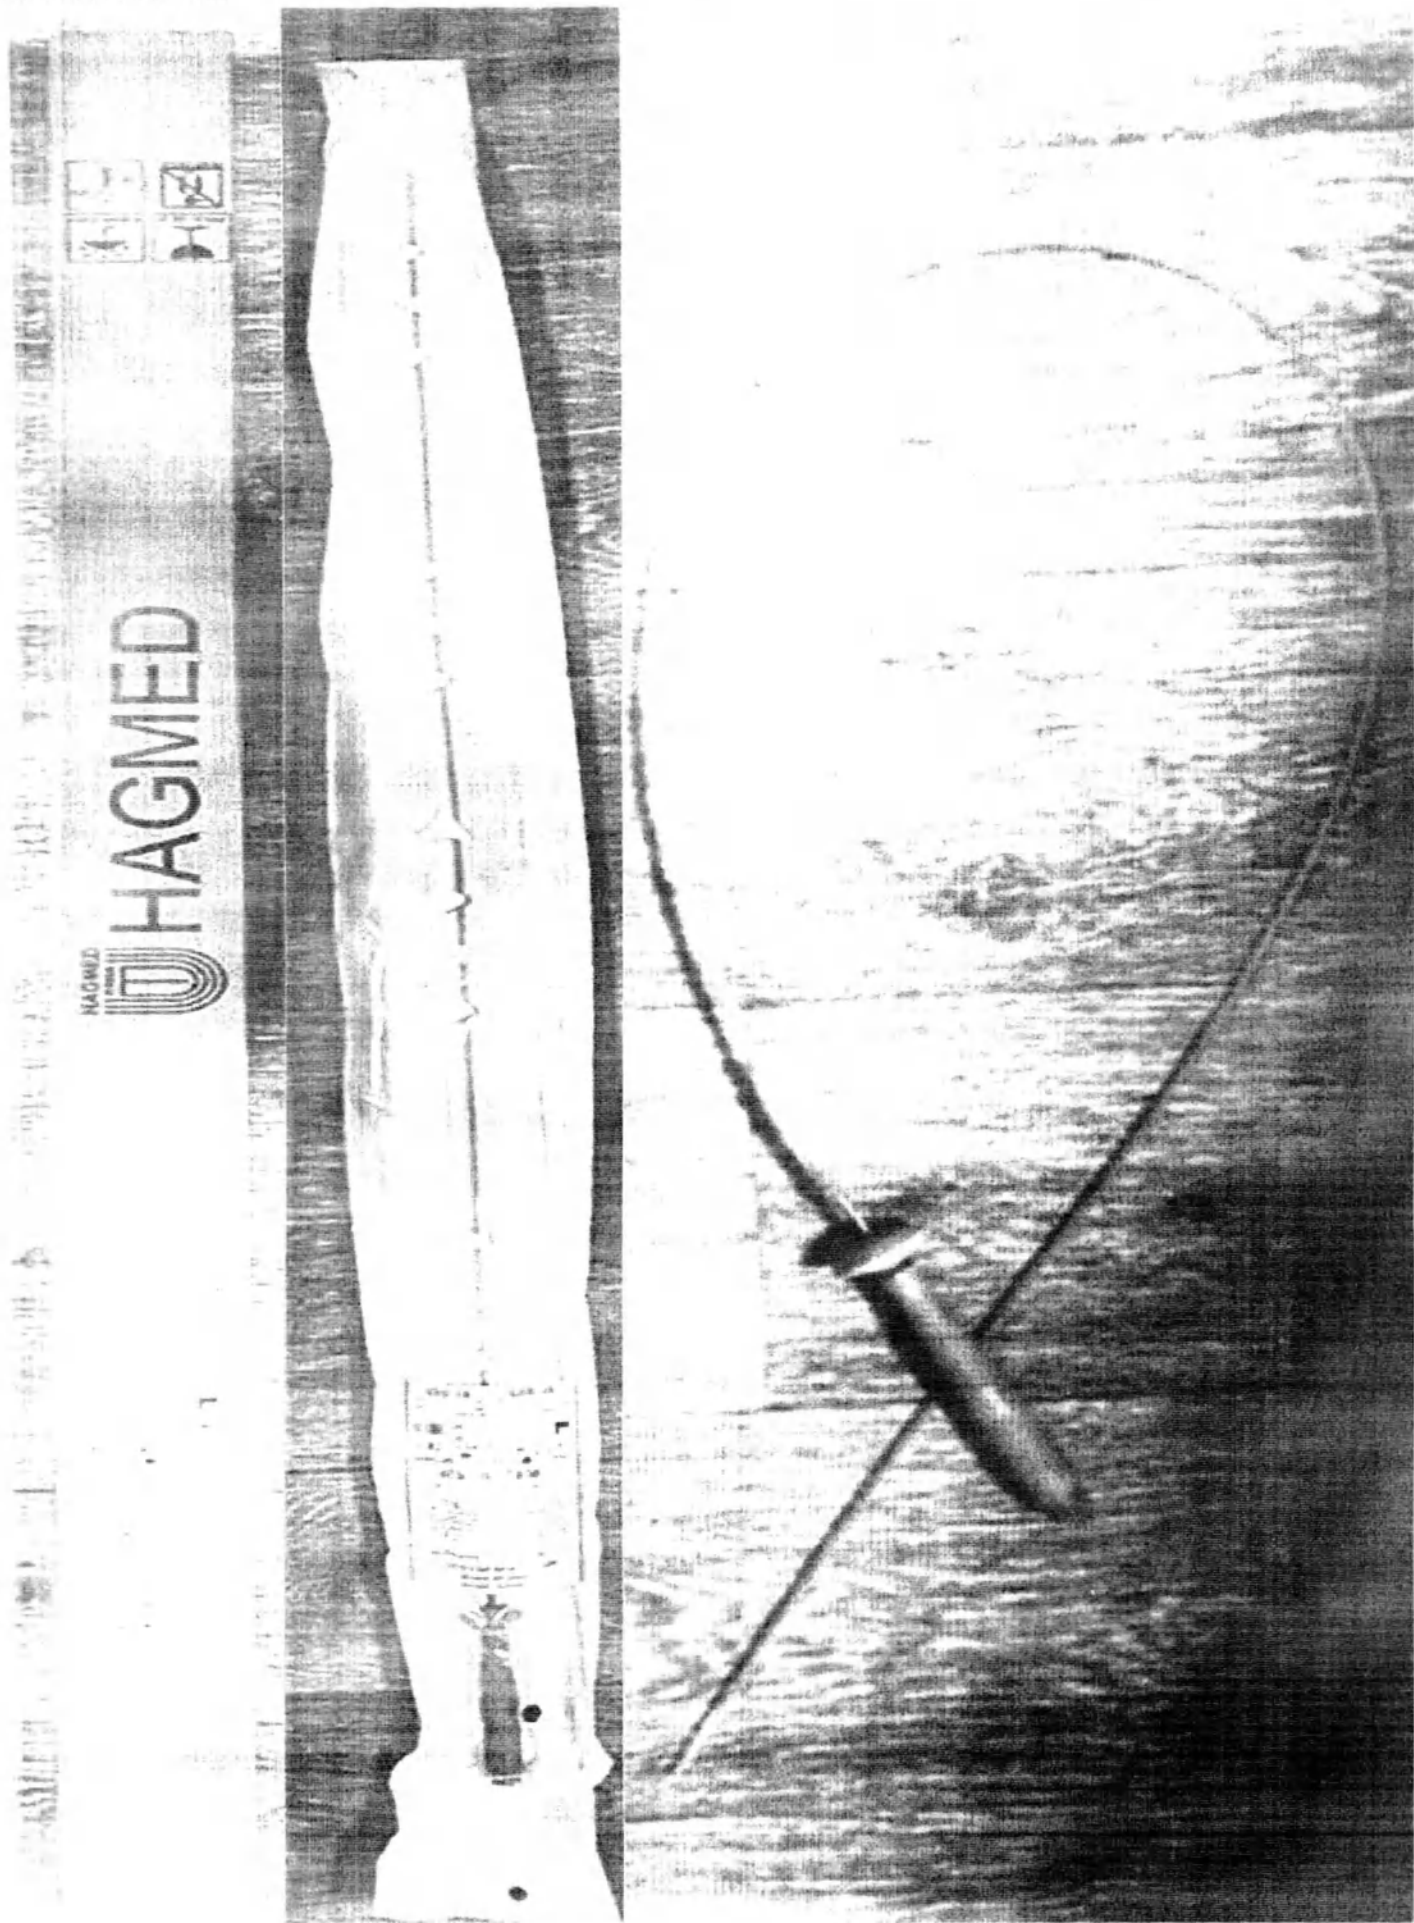


2. Катетер для мониторинга давления ИУС(ИД) А омониторинговый с иригацией или кривизной
 (с иригацией) конца «В» «S» «М» «А» - расстояние электродов 1-6-2 / 1-4-1 / 2-5-2 / 2-2-2
 диаметр 6Ф 71± 8Г готовый электрод 3,5/4,8 мм. (Потребительская упаковка. Непланируемая
 упаковка. Общий вид изделия)

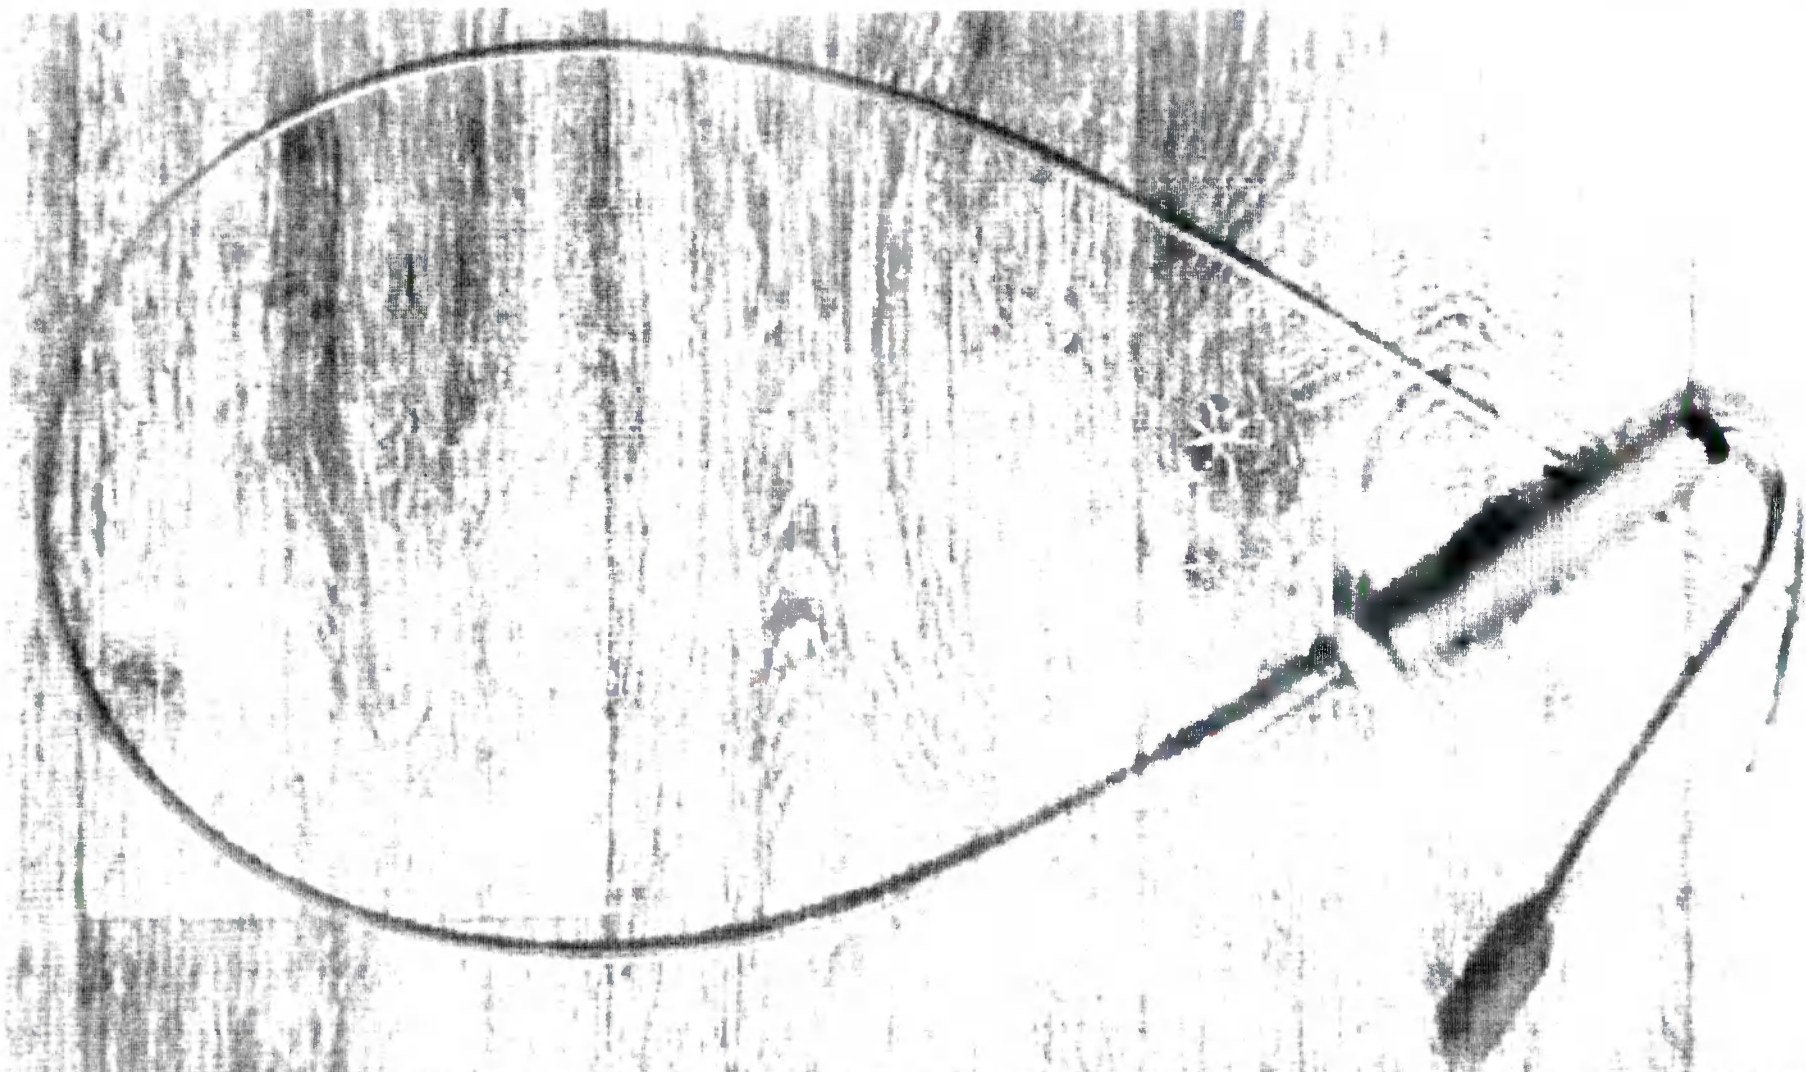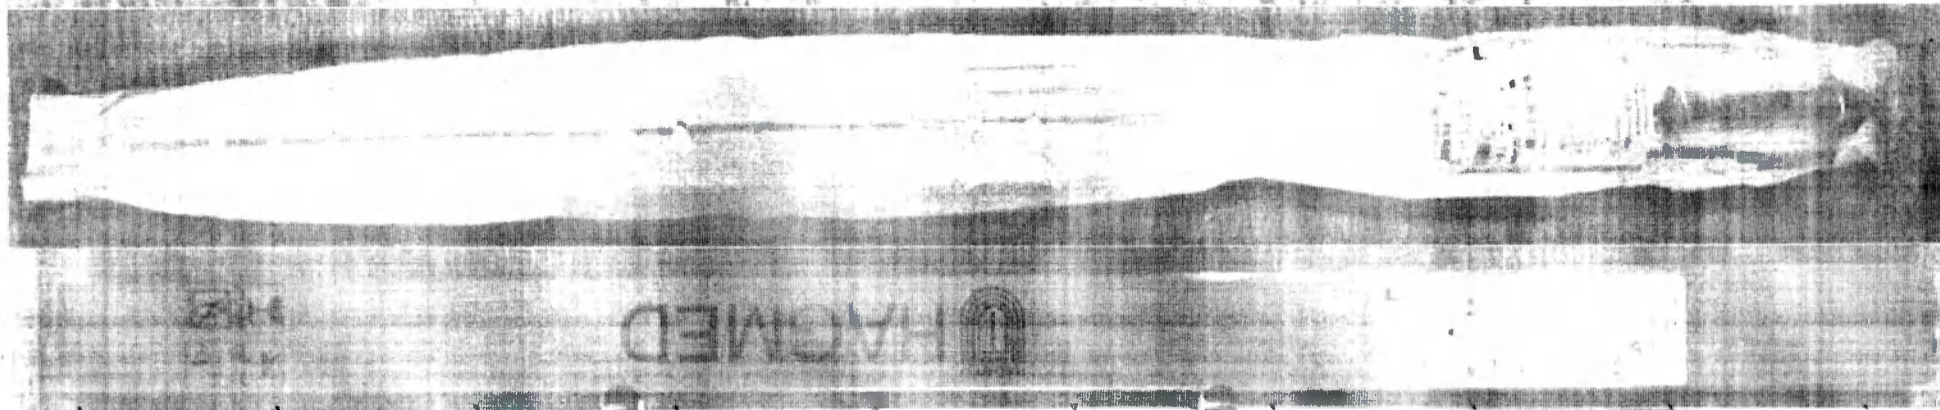


- 3- Катетер радиочастотной абляции сердца HAGMED EA двунаправленный без ирригации (ли крив) дистального конца «В», «S», «M», «L», «X» расположение электродов 1-6-2 / 1-4-1 / 2-5-2 / 2-2-2 размер 6F / 7F / 8F головной электрод 3,5 / 4 / 8 мм. (Потребительская упаковка. Индивидуальная упаковка. Общий вид изделия)

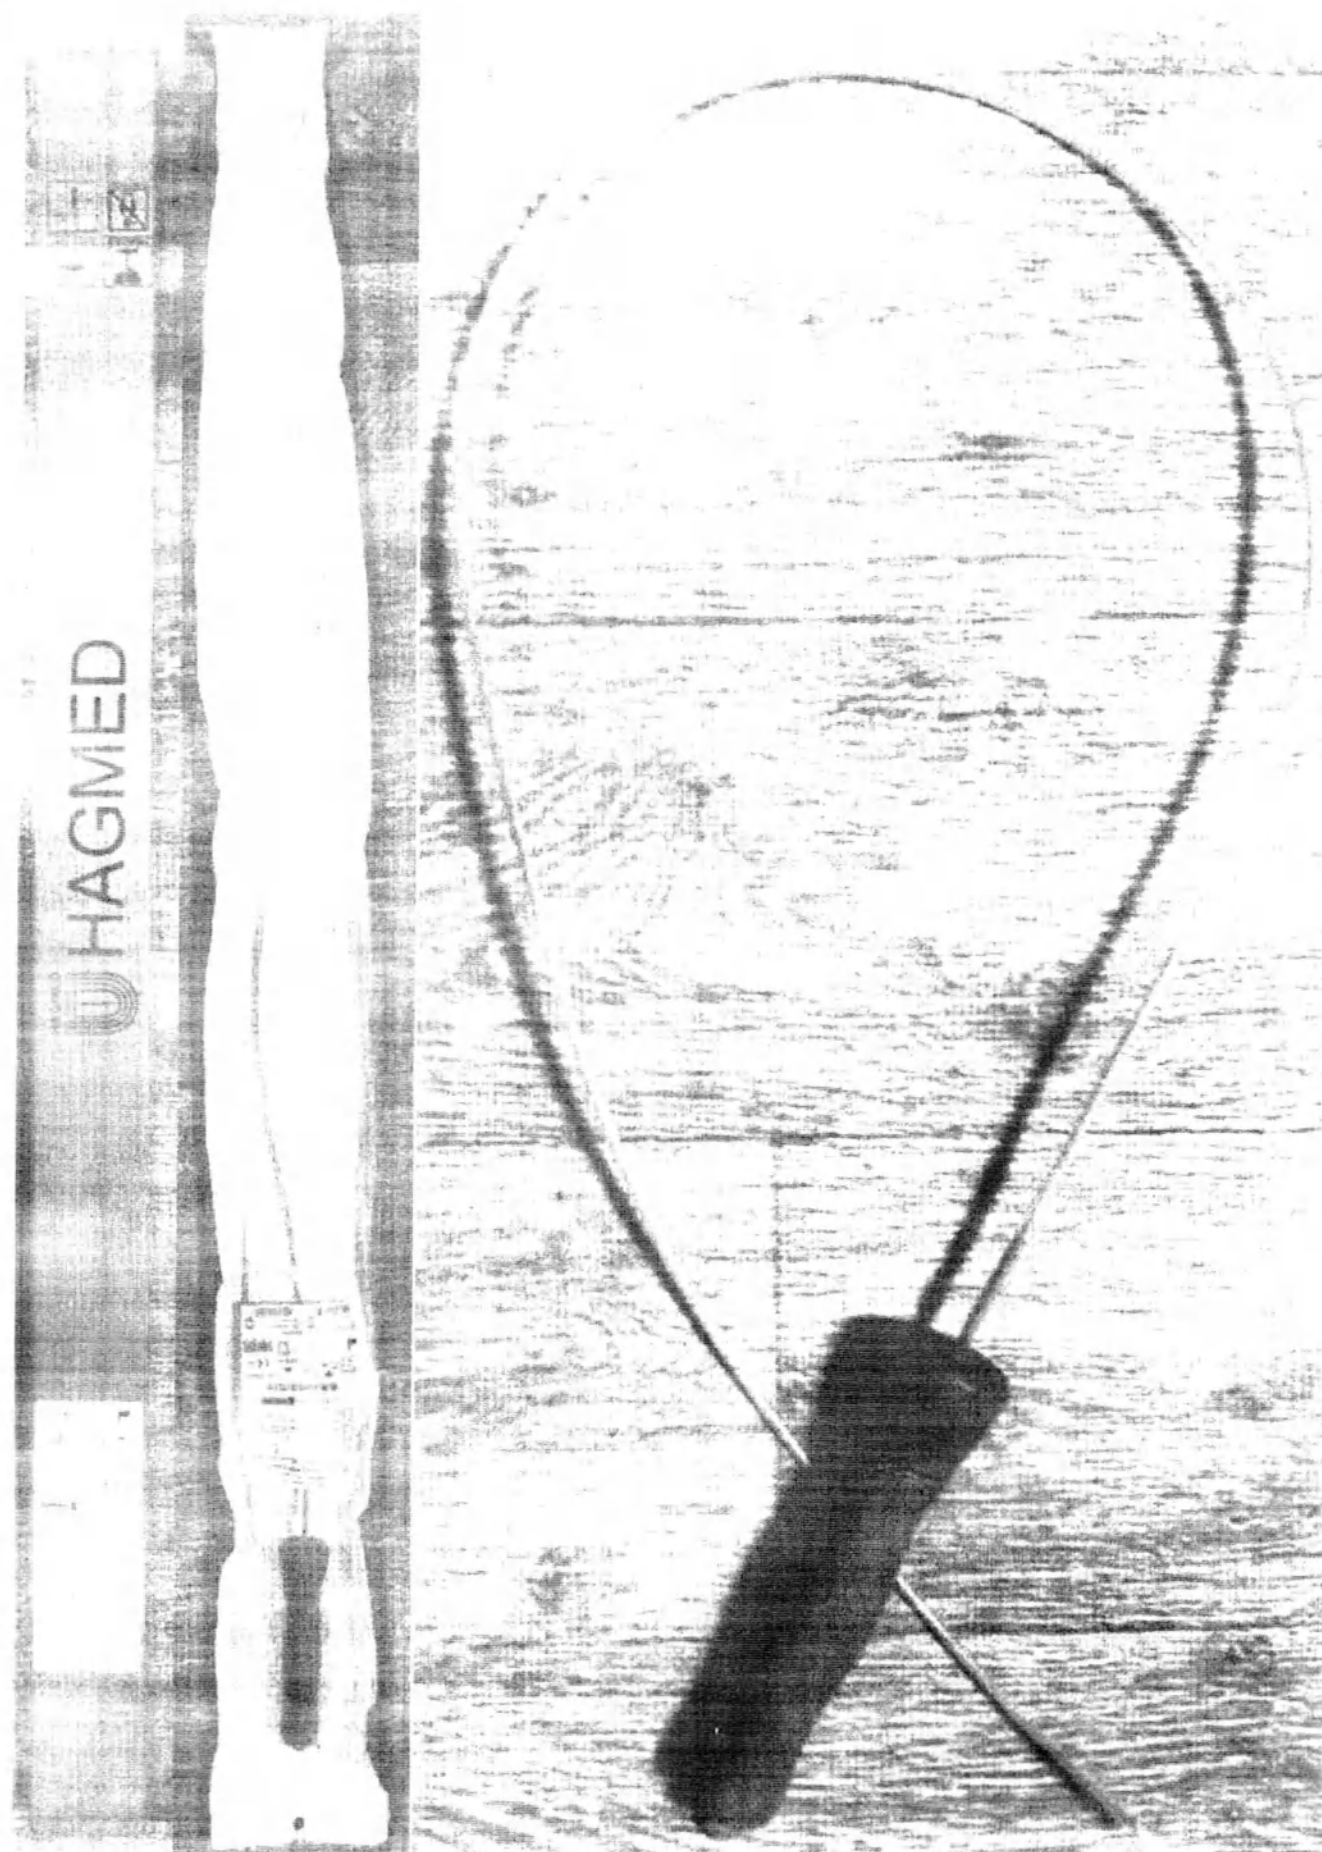

1- Катетер радиочастотной абляции сердца HAGMED EA двунаправленный с ирригацией тип кривизны
 типа «В» «S» «M» «L» «X» расположение электродов 1-6-2 / 1-4-1 / 2-5-2 / 2-2-2
 диаметр 6F 7F 8F головной электрод 3,5/4/8 мм. (Потребительская упаковка. Индивидуальная
 упаковка. Общий вид Изделия)

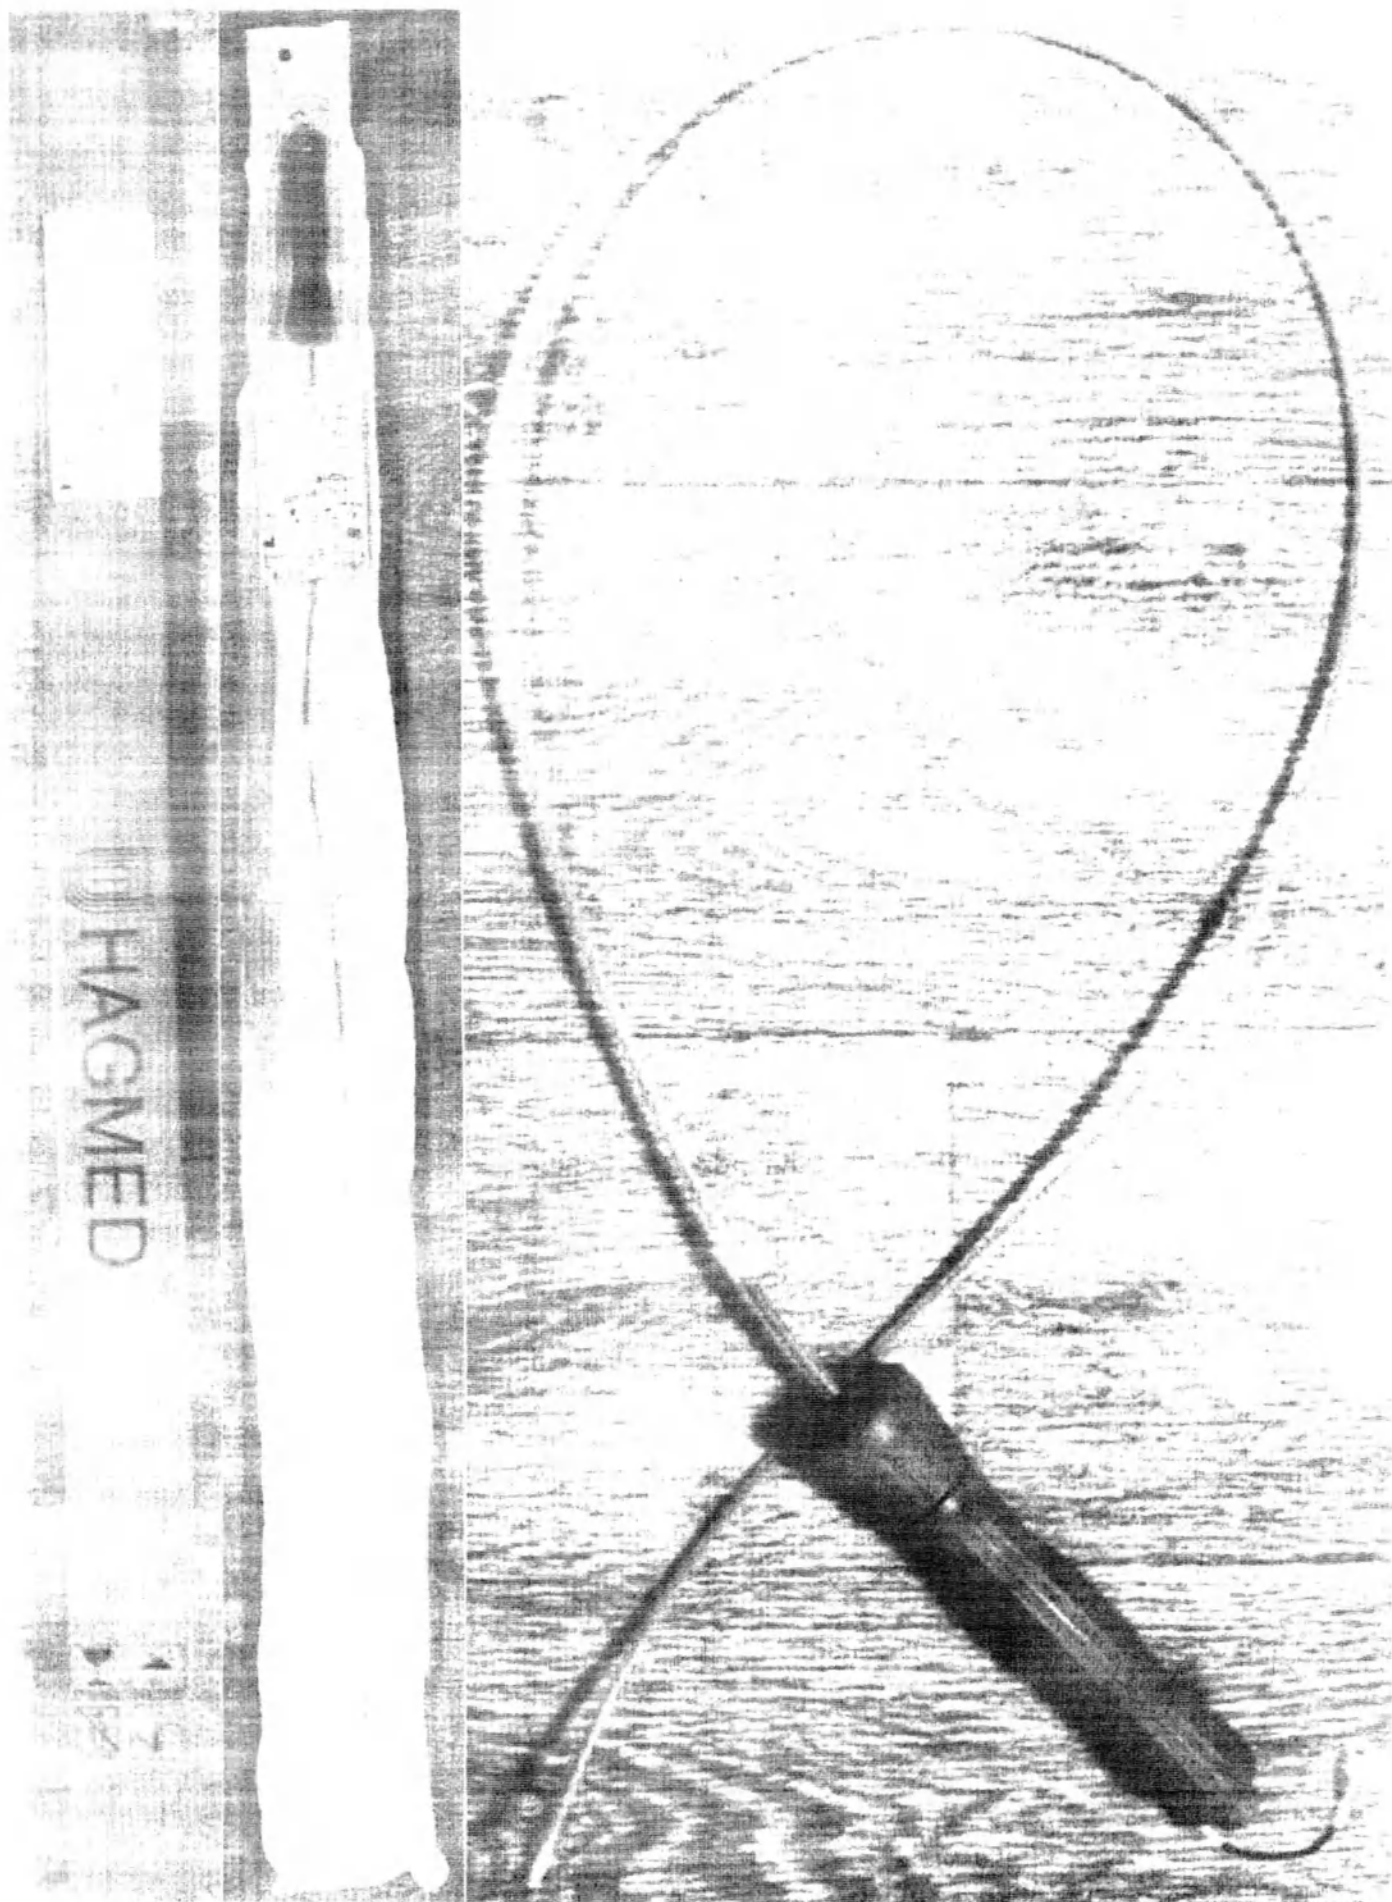

5. Система стабилизации Катетера радиочастотной абляции сердца HAGMED
Однонаправленная/Двухнаправленная Тип кривизны дистального конца «М» / «S»/ «I» размер
11.5F (Потребительская упаковка, Индивидуальная упаковка, Общий вид Изделия)

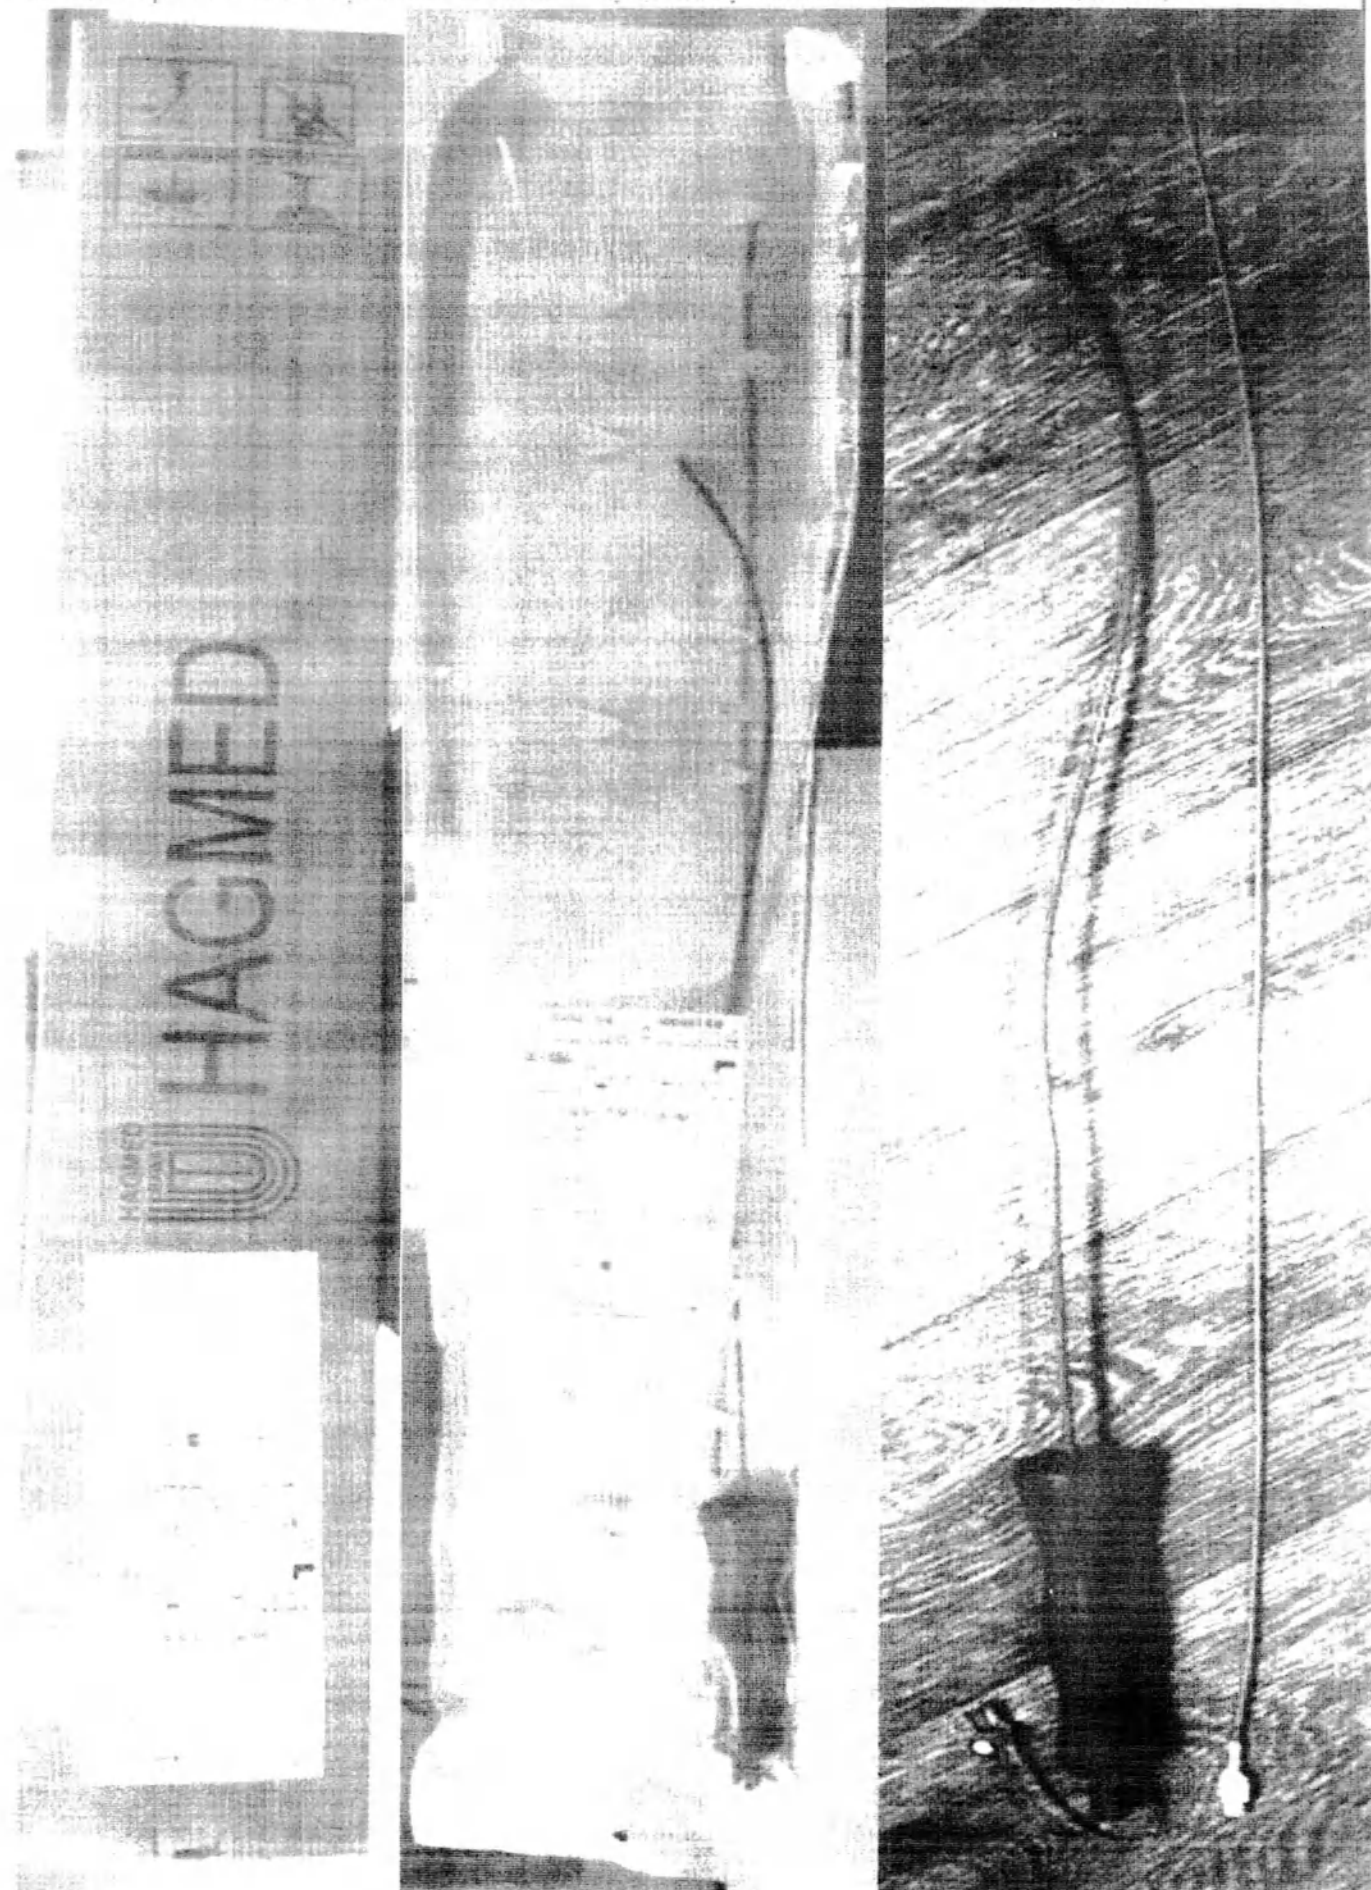

Stabilizing system of ablation electrode
System stabilizujący elektrody ablacyjnej

EAK8MU72

REF

Contents
Zawartość

Sheath introducer / Koszulka naczyniowa
Dilatator / Rozszerzacz



Sheath introducer specification / Specyfikacja koszulki naczyniowej

Inner / outer size Rozmiar wewnętrzny / zewnętrzny	3.5F / 11.5F
Size of curve Wielkość zagięcia	M
Type of steerability Typ sterowalności	Unidirectional Jednokierunkowa
Insertion length Długość robocza	72 cm

Dilatator specification / Specyfikacja rozszerzacza

Inner / outer size Rozmiar wewnętrzny / zewnętrzny	0.040" / 8F
Insertion length Długość robocza	94 cm



(01)05900672697216(17)220831(10)20200914

STERILE R LOT 20200914

2022-08



WAGMED Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 10, 05-110 Włocławek, PL
POLSKA
Tel: +48 44 614 44 00 Fax: +48 44 614 44 01
Email: info@wagmed.com.pl



MADE IN POLAND




5 900672 697216

Stabilizing system of ablation electrode
System stabilizujący elektrody ablacyjnej

REF EAK8MU72


LOT 20200914



Stabilizing system of ablation electrode
System stabilizujący elektrody ablacyjnej

REF EAK8MU72

LOT 20200914



Przedłużacz elektrody elektrofizjologicznej

REF	PEE06EA1-250
LOT	20200914
Type	Extension cable of ablation electrode, single use
Type	Przedłużacz elektrody ablastyjnej, jednorazowego użycia
Model	10-pins Redef plug / 10-pins Redef plug 10-pinowy wtyk typu Redef / 10-pinowy wtyk typu Redef
Length	250 cm
Długość	



480/1000 2:00 10-4
 480/1000 2:00 10-4
 480/1000 2:00 10-4
 480/1000 2:00 10-4



CE 1434




Extension cable
Przedłużacz elektryczny elektrofizjologiczny

REF PEE06EA1-250
LOT 20200914



Przedłużacz elektrody elektrofizjologiczne

REF PEE06EA1-250
LOT 20200914



Всего пронумеровано и сброшювано печатно-
бумажных листов

Генеральный директор ООО
«Современные медицинские технологии»

Р.Ш. Петрова

