

**Макеты этикеток индивидуальных, групповых и транспортных упаковок
медицинского изделия для диагностики *in vitro***

**Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -
сбалансированным литий гепарином**

производства SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

2024

Макеты этикеток для варианта исполнения: Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 1 мл, без индивидуальной упаковки, 50 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки:

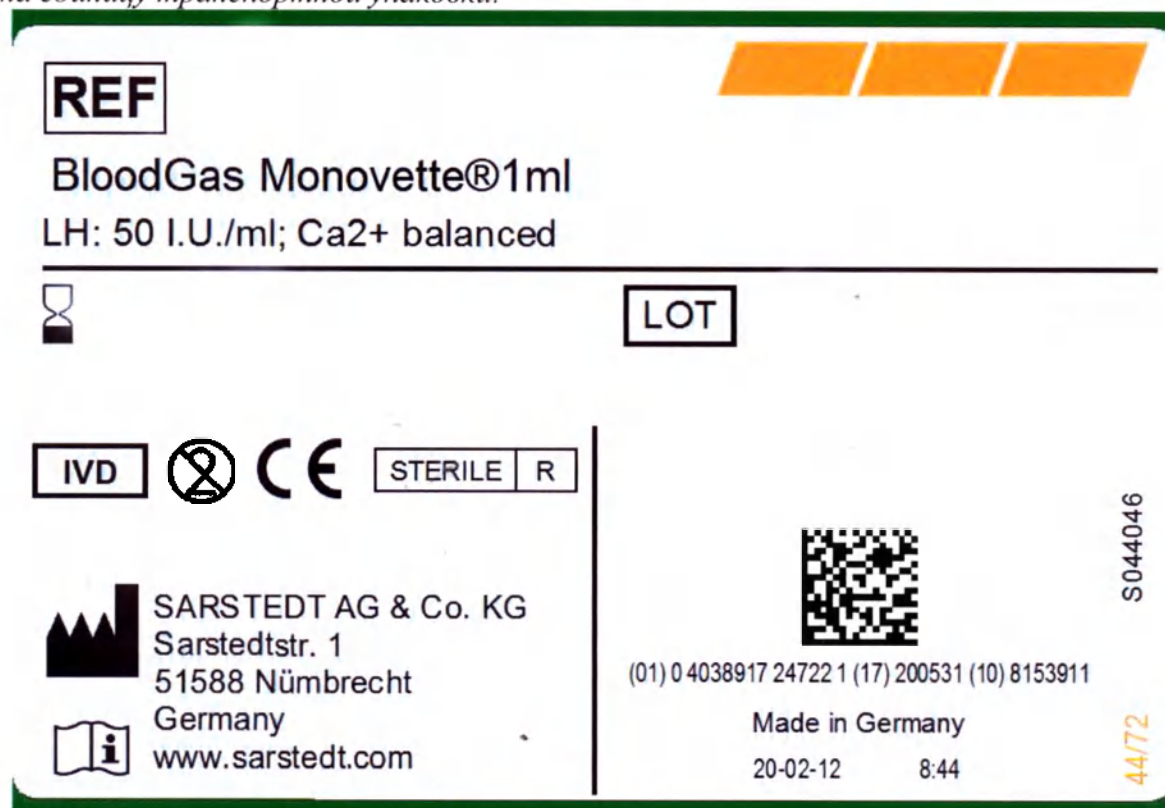


Рисунок 1. Макет этикетки на групповой упаковке.

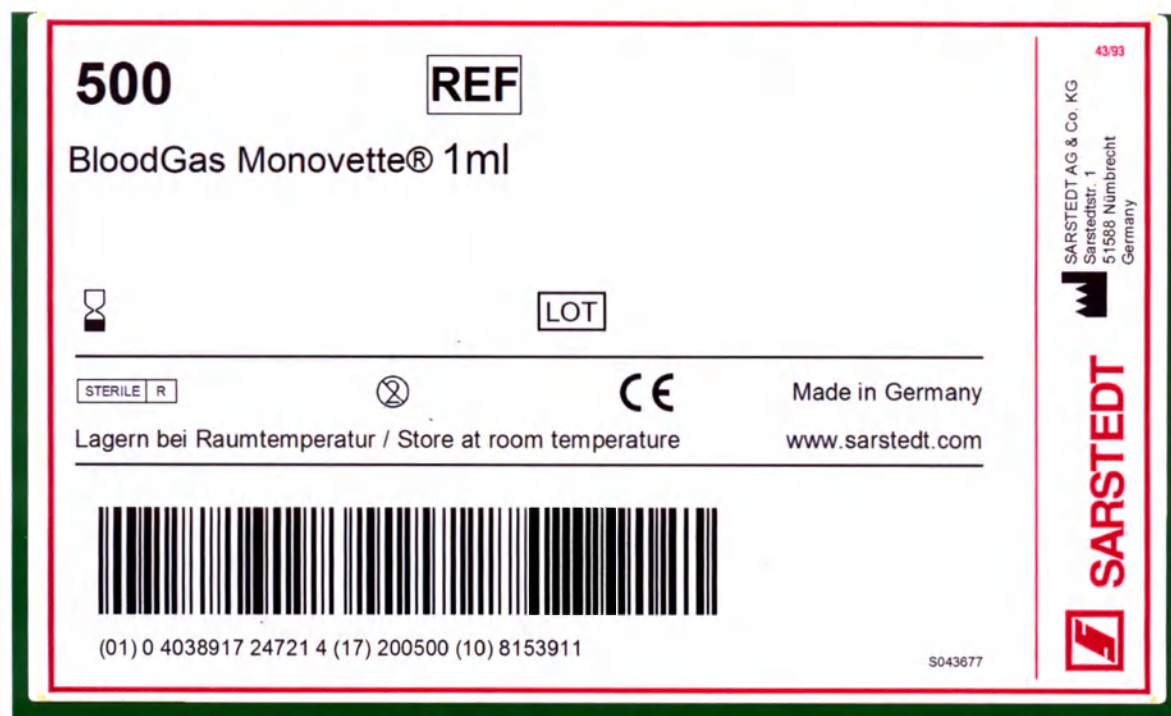


Рисунок 2. Макет этикетки на транспортной упаковке.

REF

Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 1 мл, без индивидуальной упаковки, 50 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения и транспортирования при температуре от +4 до +25°C, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Рисунок 3. Макет русскоязычной этикетки на групповой и транспортной упаковке.

Макеты этикеток для варианта исполнения: Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 1 мл, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки.



Рисунок 4*. Препринт с маркировкой на индивидуальной упаковке

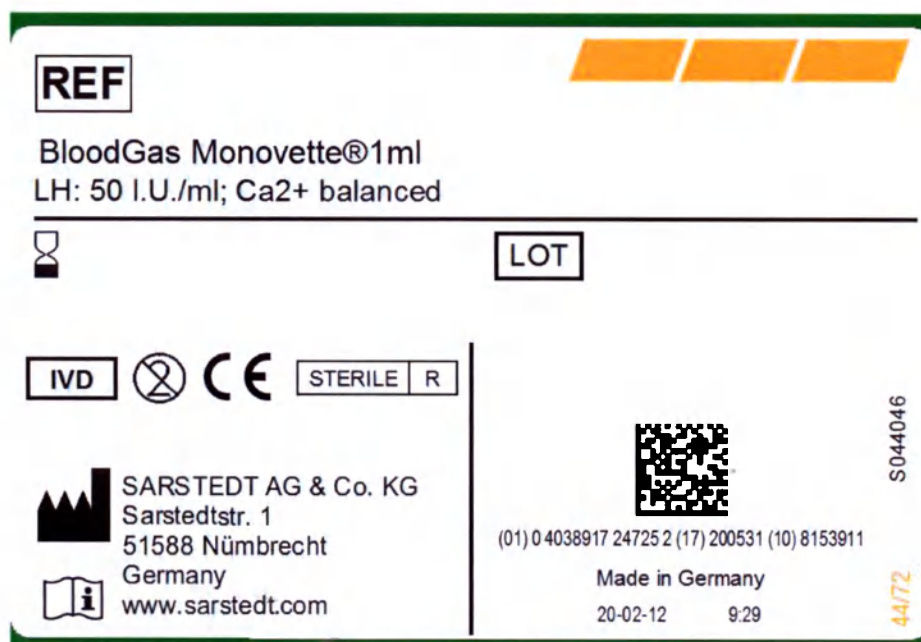


Рисунок 5. Макет этикетки на **групповой** упаковке

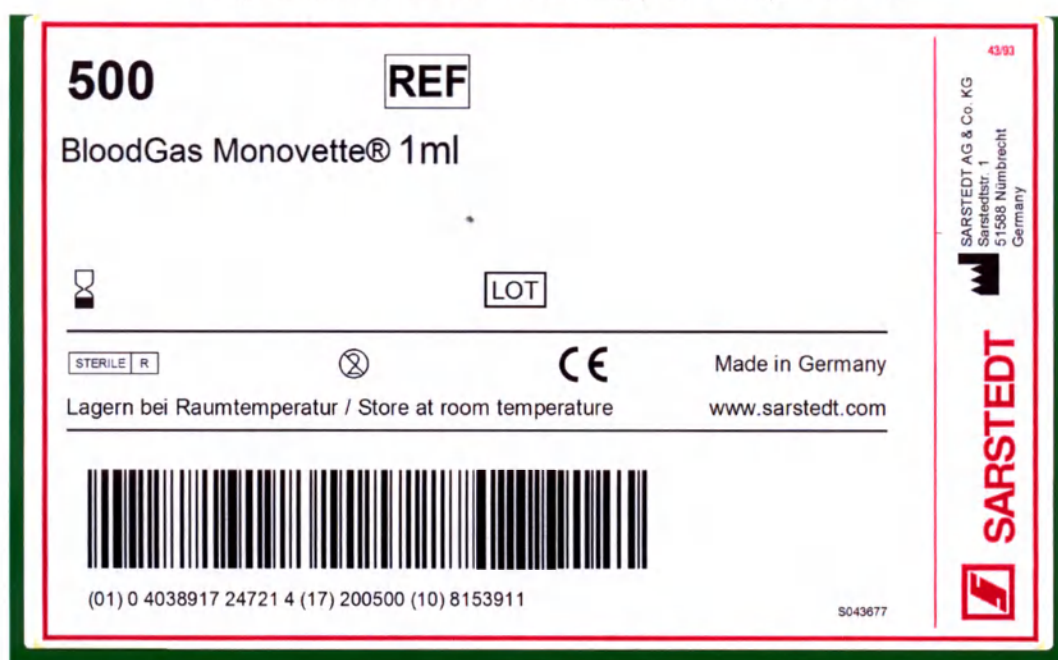


Рисунок 6. Макет этикетки на **транспортной** упаковке

REF

Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 1 мл, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения и транспортирования при температуре от +4 до +25°C, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Рисунок 7. Макет русскоязычной этикетки на групповой и транспортной упаковке.

Макеты этикеток для варианта исполнения: Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, без индивидуальной упаковки, 50 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки.

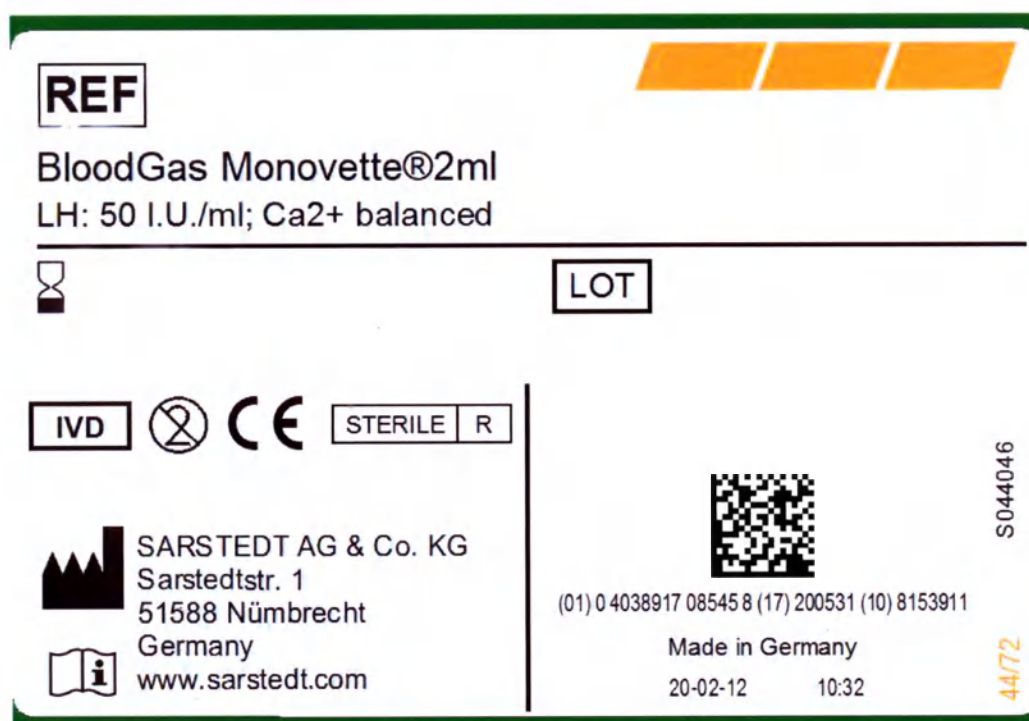


Рисунок 8. Макет этикетки на групповой упаковке

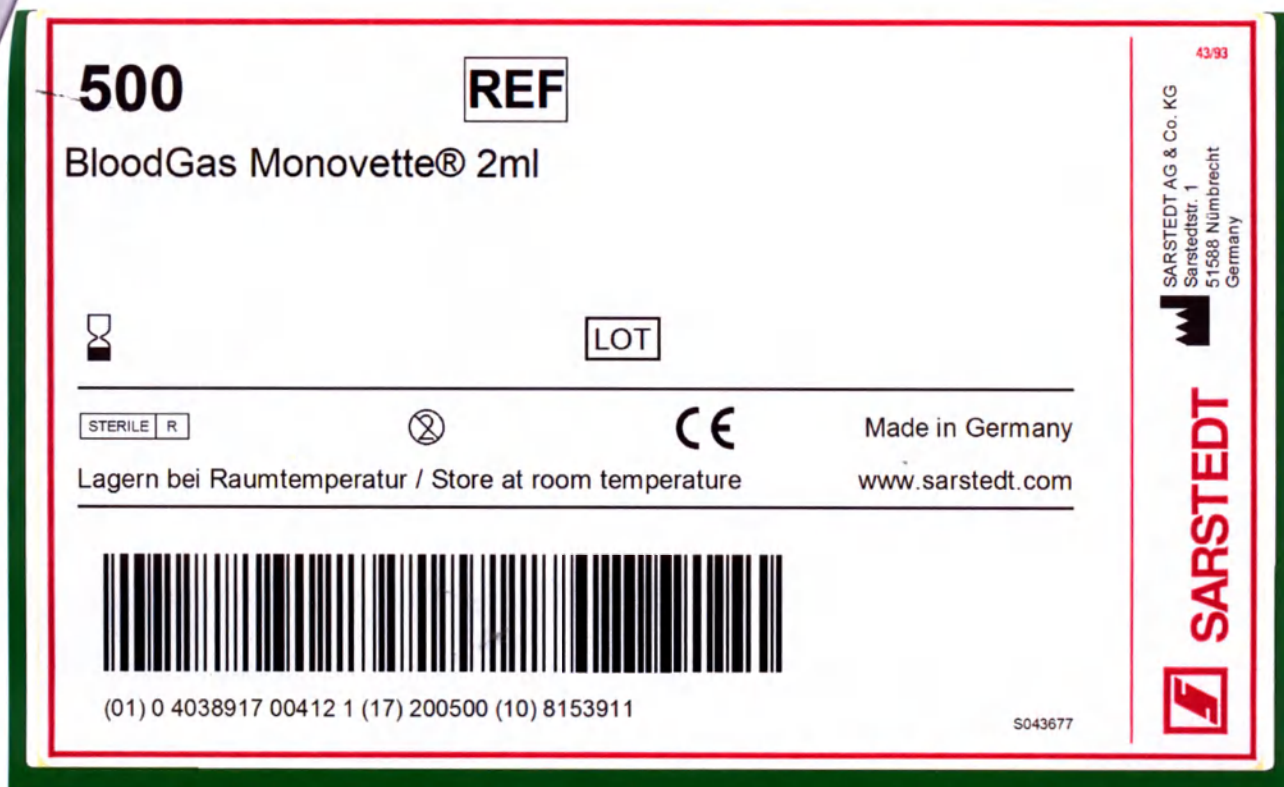


Рисунок 9. Макет этикетки на **транспортной** упаковке

REF
Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, без индивидуальной упаковки, 50 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки. Номер партии: см. на упаковке. Срок годности: см. на упаковке. Условия хранения и транспортирования при температуре от +4 до +25°C, относительной влажности не более 80%. РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия). Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207 Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28 e-mail: info.ru@sarstedt.com
 SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Рисунок 10. Макет русскоязычной этикетки на **групповой и транспортной** упаковке.

Макеты этикеток для варианта исполнения: Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки.



Рисунок 11*. Препринт с маркировкой на **индивидуальной** упаковке.



Рисунок 12. Макет этикетки на **групповой** упаковке.

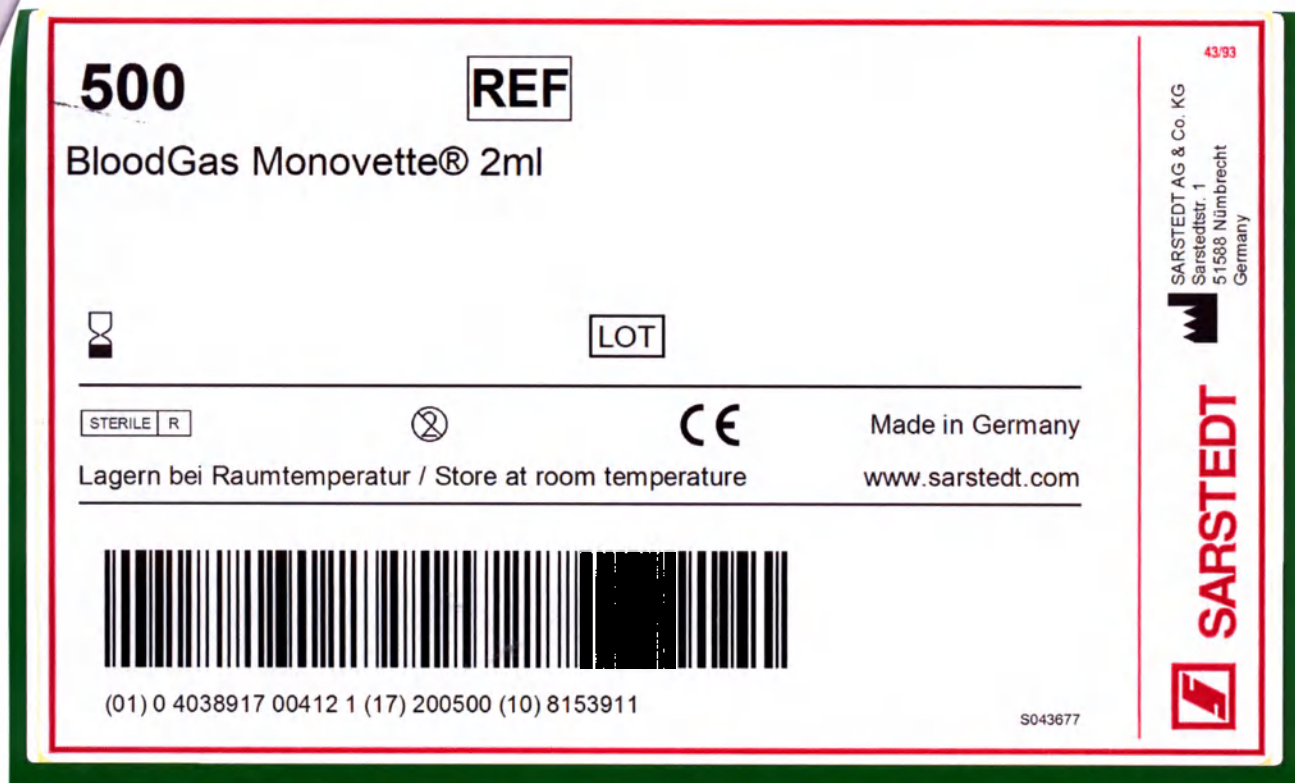


Рисунок 13. Макет этикетки на **транспортной** упаковке.

REF
Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+}-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+}-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки. Номер партии: см. на упаковке. Срок годности: см. на упаковке. Условия хранения и транспортирования при температуре от +4 до +25°C, относительной влажности не более 80%. РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия). Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207 Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28 e-mail: info.ru@sarstedt.com
 SARSTEDT AG & Co.KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Рисунок 2. Макет русскоязычной этикетки на **групповой и транспортной** упаковке.

Макеты этикеток для варианта исполнения: Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, с переходником (адаптером) мембранным, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки.

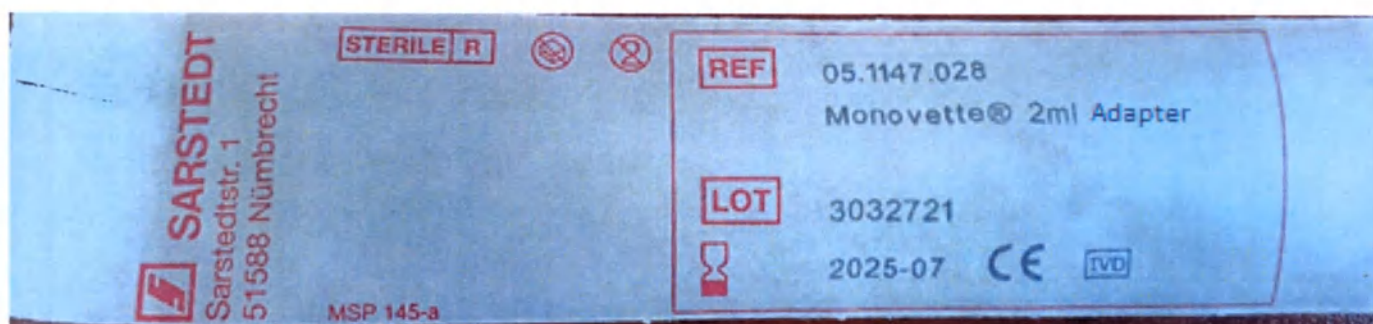


Рисунок 15*. Препринт с маркировкой на **индивидуальной** упаковке.

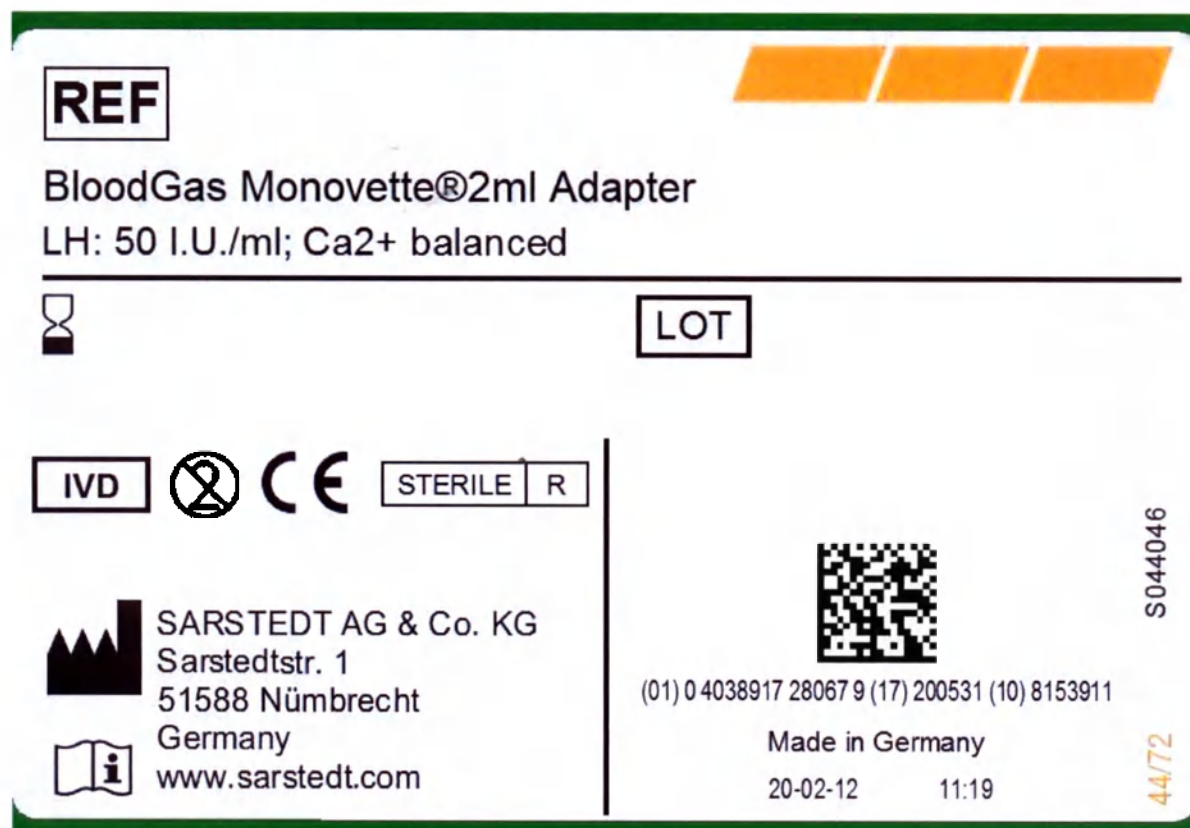


Рисунок 16. Макет этикетки на **групповой** упаковке.

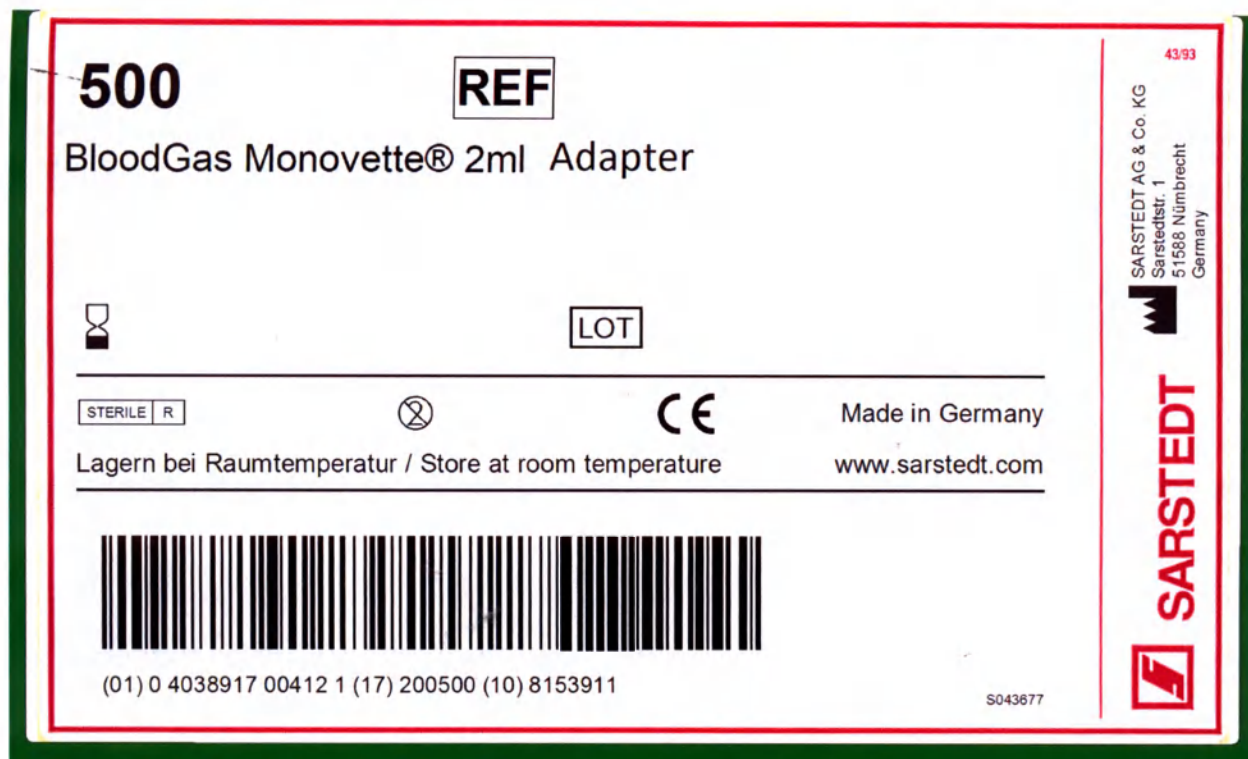


Рисунок 17. Макет этикетки на транспортной упаковке.

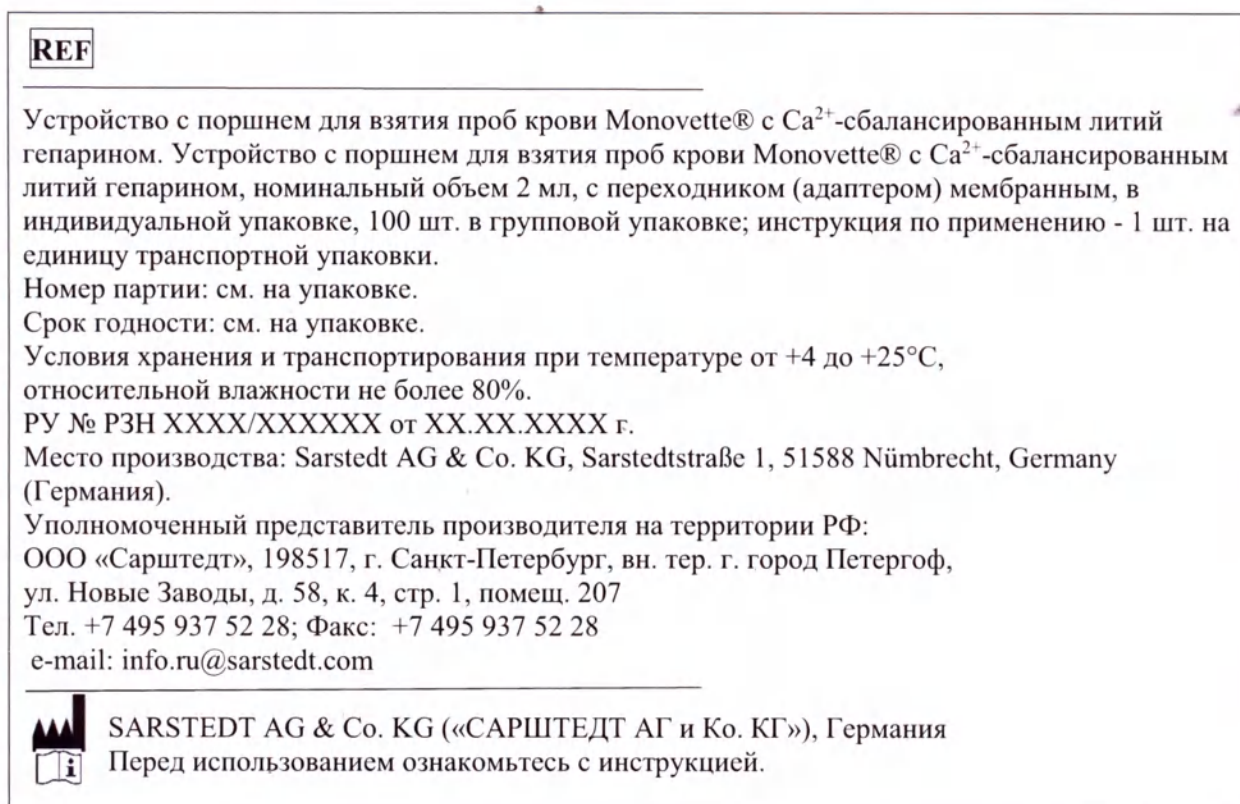


Рисунок 18. Макет русскоязычной этикетки на групповой и транспортной упаковке.

Макеты этикеток для варианта исполнения: Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, с воздушным фильтром, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки.

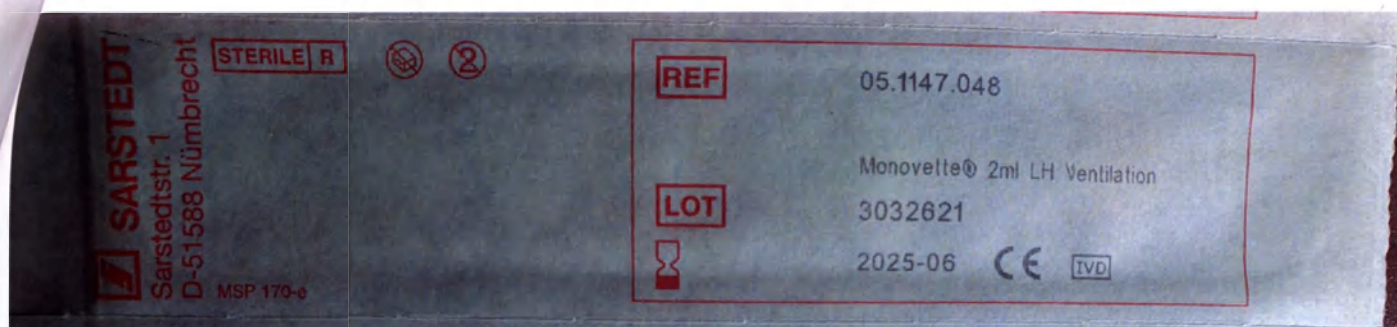


Рисунок 19*. Препринт с маркировкой на **индивидуальной** упаковке.

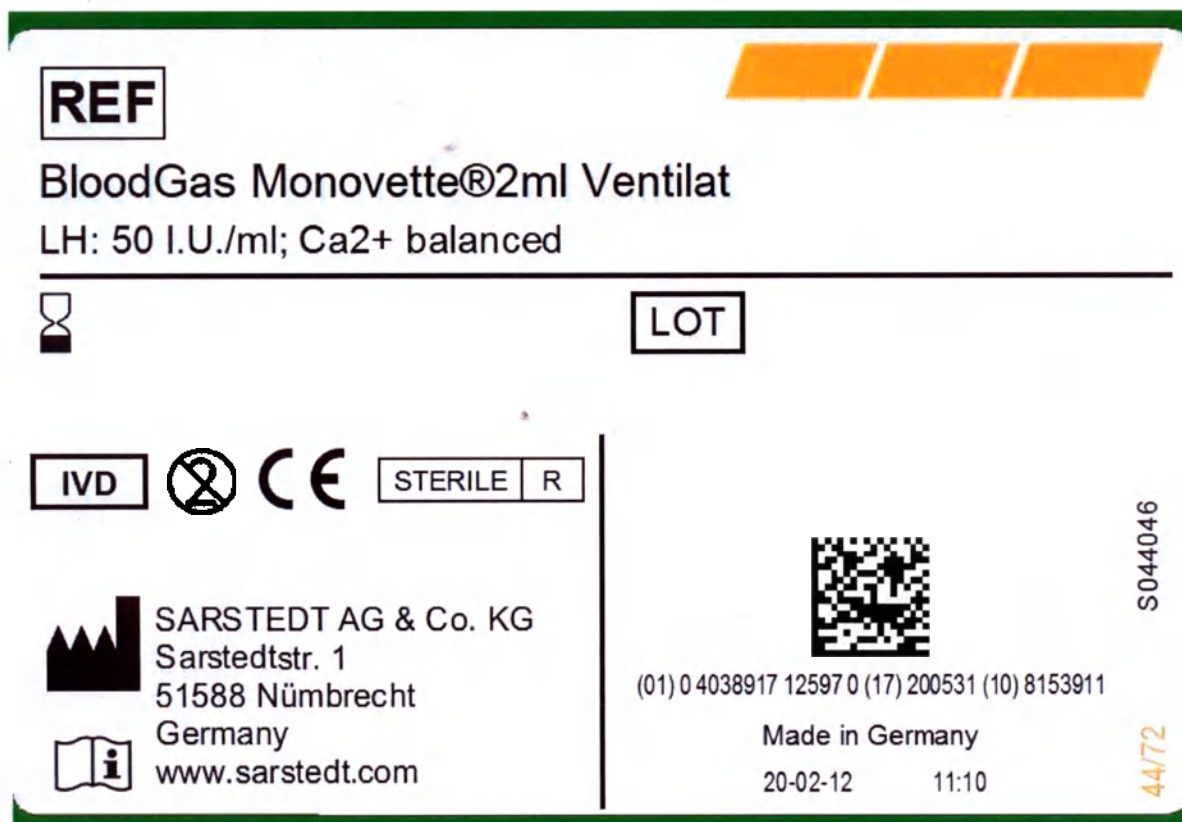


Рисунок 20. Макет этикетки на **групповой** упаковке.

500**REF****BloodGas Monovette® 2ml Ventil****LOT**

STERILE R

**CE**

Made in Germany

Lagern bei Raumtemperatur / Store at room temperature

www.sarstedt.com



(01) 0 4038917 00412 1 (17) 200500 (10) 8153911

S043677

43/93
SARSTEDT AG & Co. KG
Sarstedtstr. 1
51588 Nümbrecht
Germany**SARSTEDT**Рисунок 21. Макет этикетки на **транспортной** упаковке.**REF**

Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, с воздушным фильтром, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения и транспортирования при температуре от +4 до +25°C, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Рисунок 22. Макет русскоязычной этикетки на **групповой и транспортной** упаковке.

прошито,
пронумеровано
и скреплено печатью
12 листа (-ов)
Генеральный директор
ООО «Сарштедт»
Белукин А. В.



Фотографические изображения медицинского изделия

Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином

производства SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

2024



Рисунок 1. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 1 мл:

- без индивидуальной упаковки, 50 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки.
- в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки.



Рисунок 2. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 1 мл, без индивидуальной упаковки, 50 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки. Групповая упаковка (общий вид).



Рисунок 3. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 1 мл, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки. В групповой упаковке (Общий вид-1).



Рисунок 4. **Фотографическое изображение** Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем **1 мл**, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки. **В групповой упаковке (Общий вид-2).**

Артикулы могут быть изменены по решению производителя



Рисунок 5. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл:

- без индивидуальной упаковки, 50 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки.
- в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки.



Рисунок 6. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, без индивидуальной упаковки, 50 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки. **В групповой упаковке (Общий вид).**



Рисунок 7. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки. Групповая упаковка (Общий вид-1).



Рисунок 8. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки. Групповая упаковка (общий вид-2).



Рисунок 9. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, с переходником (адаптером) мембранным, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки.

Артикулы могут быть изменены по решению производителя



Рисунок 10. **Фотографическое изображение** Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, с **переходником (адаптером) мембранным**, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки. **Групповая упаковка** (общий вид-1).



Рисунок 11. **Фотографическое изображение** Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, с **переходником (адаптером) мембранным**, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки. **Групповая упаковка** (общий вид-2).



Рисунок 12. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, с воздушным фильтром, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки.

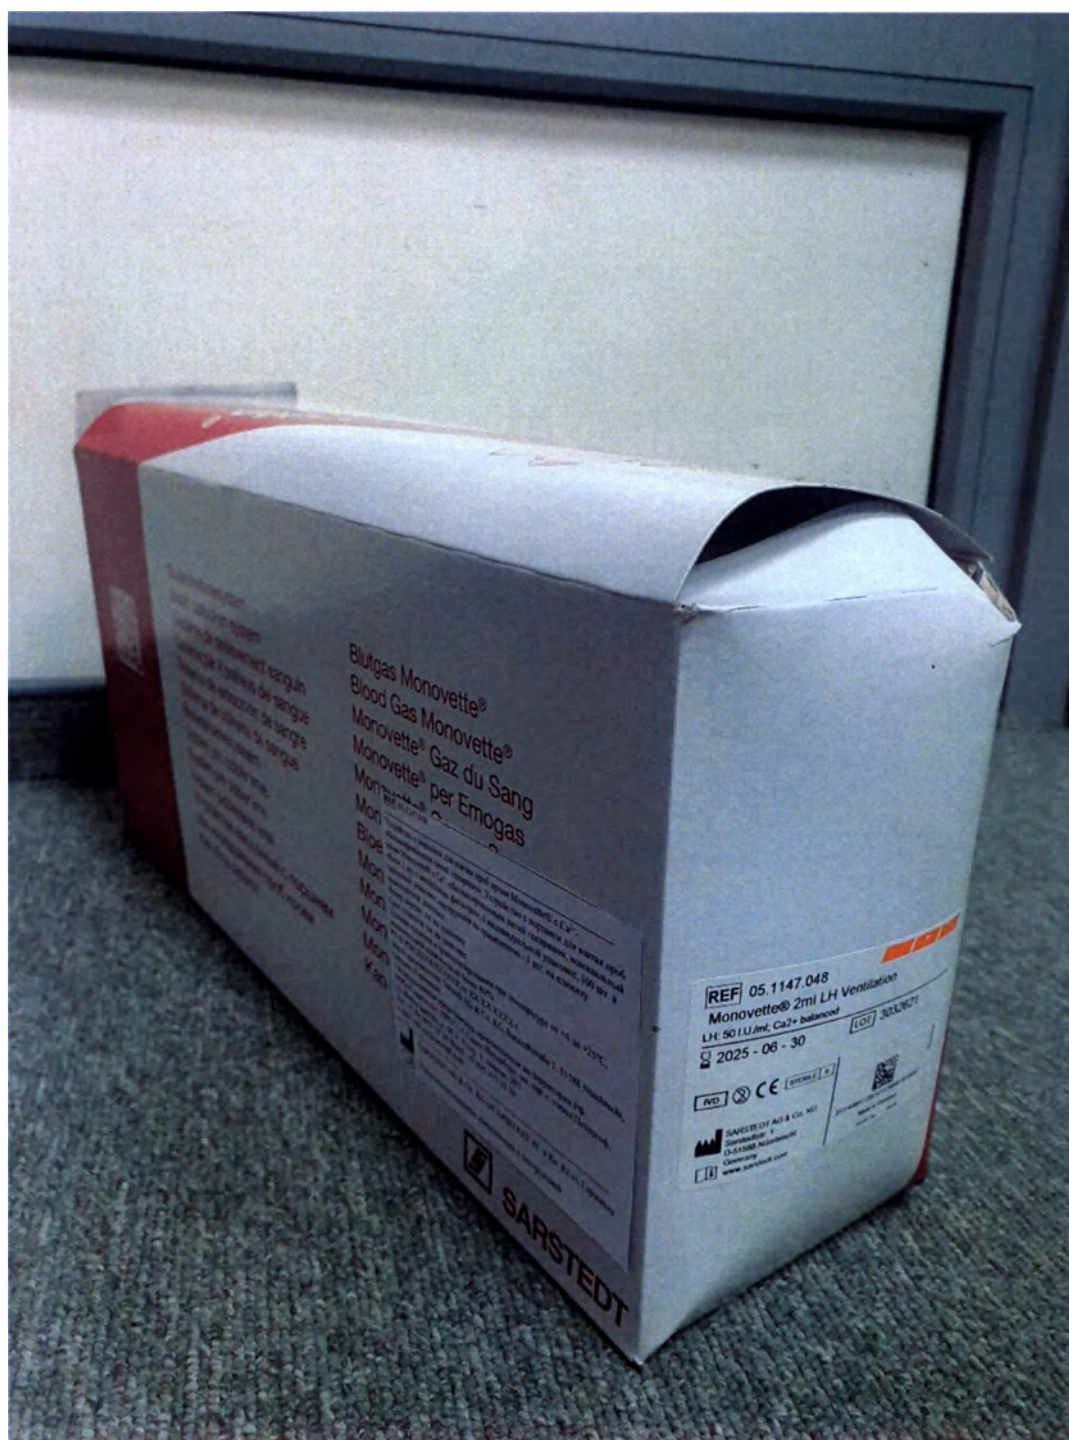


Рисунок 13. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, с воздушным фильтром, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки. Групповая упаковка (общий вид - 1).



Рисунок 14. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca^{2+} -сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, с воздушным фильтром, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки. Групповая упаковка (общий вид -2).

Фотографические изображения изделий в транспортной упаковке:



рисунк 15. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 1 мл, без индивидуальной упаковки, 50 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки.



Рисунок 16. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем **1 мл**, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки. Транспортная упаковка.



Рисунок 17. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем **2 мл**, без индивидуальной упаковки, 50 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки. Транспортная упаковка.



Рисунок 18. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению – 1 шт. на единицу транспортной упаковки.



Рисунок 19. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca²⁺-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, с переходником (адаптером) мембранным, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки. Транспортная упаковка.



Рисунок 20. Фотографическое изображение Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca2+-сбалансированным литий гепарином. Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca2+-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 2 мл, с воздушным фильтром, в индивидуальной упаковке, 100 шт. в групповой упаковке; инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки. **Транспортная упаковка.**

Прошито,
пронумеровано
и скреплено печатью
19 листа (-ов)
Генеральный директор
ООО «Сарштедт»
Белунин А.В.

