

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТЕРЗИС»

А.Ф. Бариев

«5» марта 2024 г.



Фотографические изображения

**Набор ирригационных трубок для электрофизиологических
процедур в кардиологии
по ТУ 32.50.13-001-56958011-2023**



2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**Набор ирригационных трубок для электрофизиологических процедур в
кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023**

Транспортная упаковка



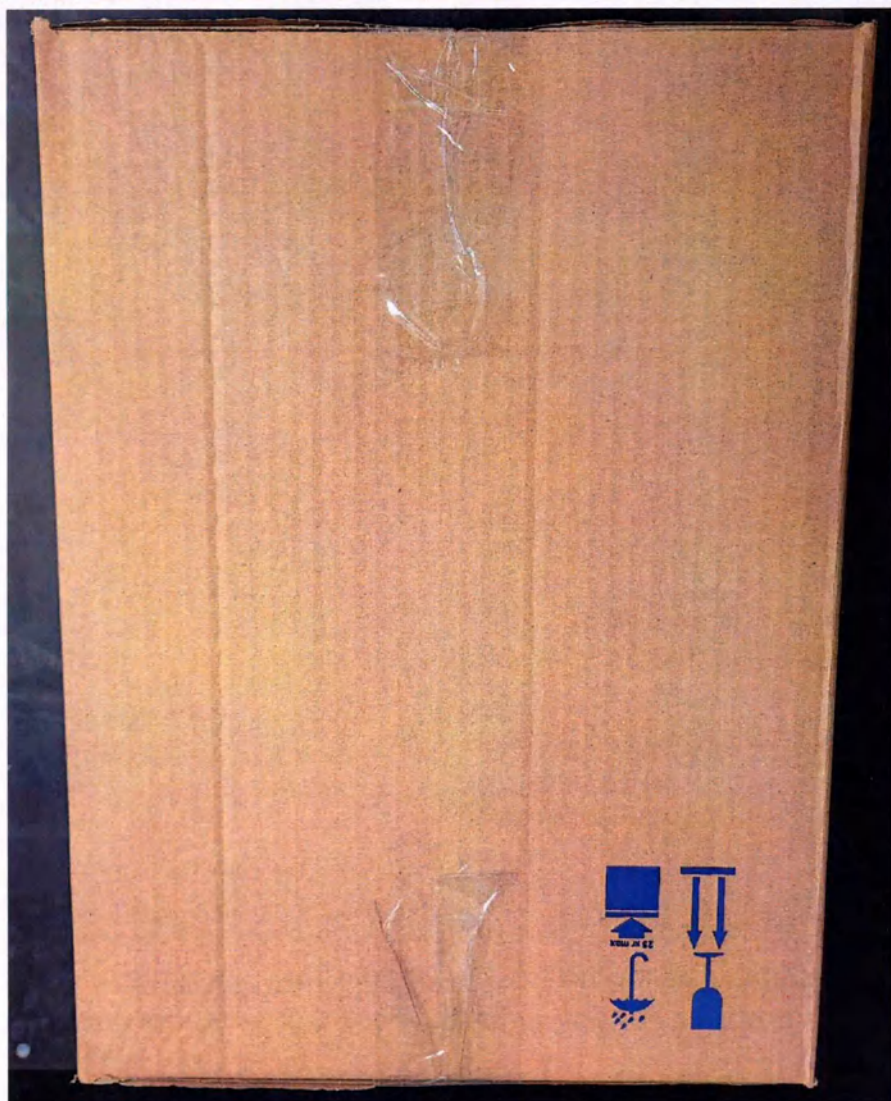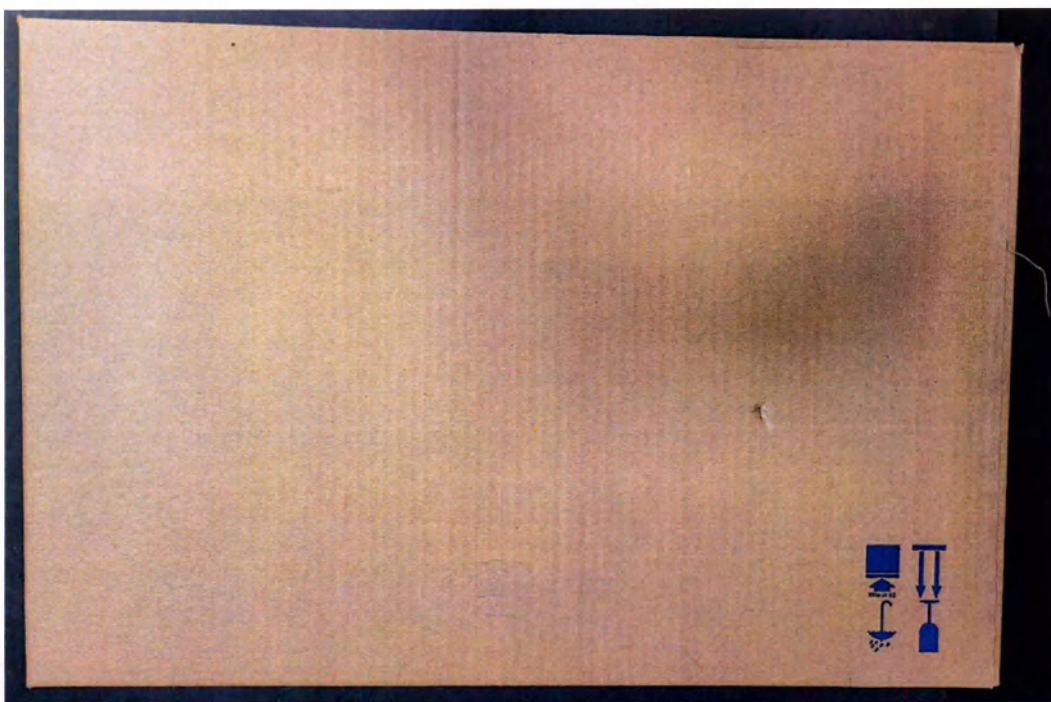

Маркировка транспортной упаковки

Набор ирригационных трубок «Синтеза Х» для электрофизиологических процедур в кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Набор ирригационных трубок для электрофизиологических процедур в кардиологии

по ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Набор ирригационных трубок «Синтеза Х» для электрофизиологических процедур в кардиологии, в составе:

- Трубка с капельницей с иглой - 1 шт.
- Стопорный клапан - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.



X010923

Регистрационное удостоверение _____
Количество изделий в упаковке _____



Производитель:

ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

Место производства:

1. Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ИНТЕРОКО» (АО «НПП «ИНТЕРОКО»), 140080, Россия, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер. промзона Тураево, стр. 8, здание 121

2. Акционерное общество

«Татхимфармпрепараты» (АО «Татхимфармпрепараты»),
420091, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260.

Условия транспортирования:

-50°C  +50°C относительная влажности воздуха до 100% при 25°C.

Условия хранения:

1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Маркировка транспортной упаковки

Набор ирригационных трубок «Синтеза» для электрофизиологических процедур в кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Набор ирригационных трубок для электрофизиологических процедур в кардиологии по ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Набор ирригационных трубок «Синтеза» для электрофизиологических процедур в кардиологии, в составе:

- Трубка с капельницей с иглой - 1 шт.
- Стопорный клапан - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.



010923

Регистрационное удостоверение _____
Количество изделий в упаковке _____

Производитель:

ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9


Место производства:

1. Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ИНТЕРОКО» (АО «НПП «ИНТЕРОКО»), 140080, Россия, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер. промзона Тураево, стр. 8, здание 121

2. Акционерное общество

«Татхимфармпрепараты» (АО «Татхимфармпрепараты»),
420091, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260.

Условия транспортирования:



+50°C

относительная влажности воздуха до
100% при 25°C.

-50°C

Условия хранения:

1 (I) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.




Набор ирригационных трубок «Синтеза Х» для электрофизиологических
процедур в кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Индивидуальная упаковка




Набор ирригационных трубок «Синтеза Х» для электрофизиологических процедур в кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Маркировка индивидуальной упаковки

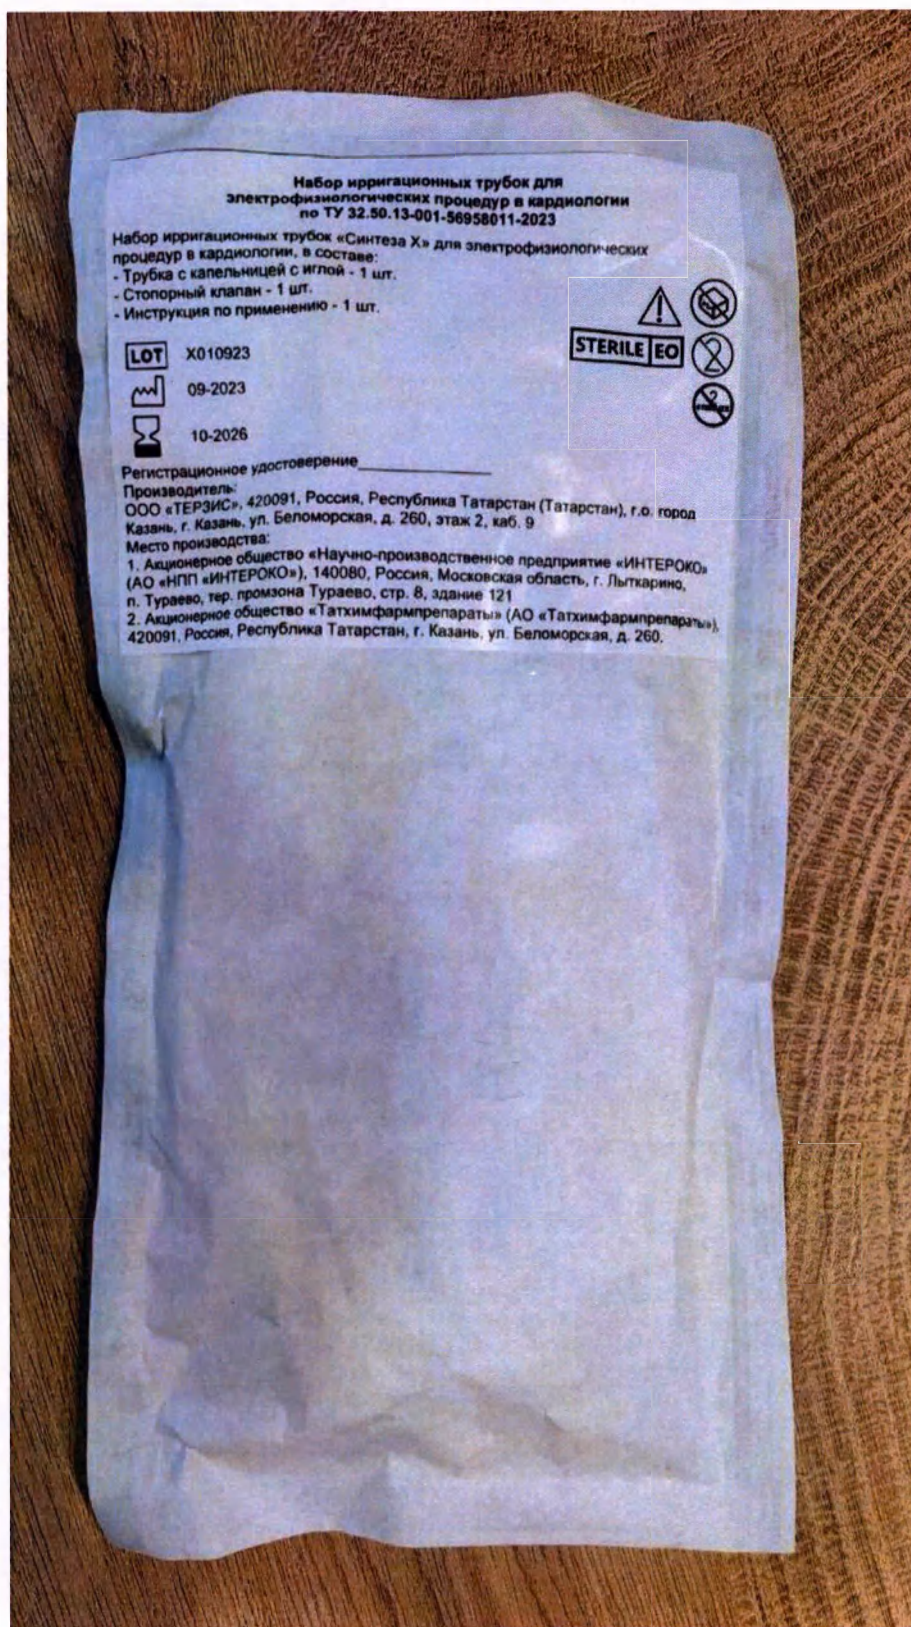


Набор ирригационных трубок «Синтеза Х» для электрофизиологических процедур в кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

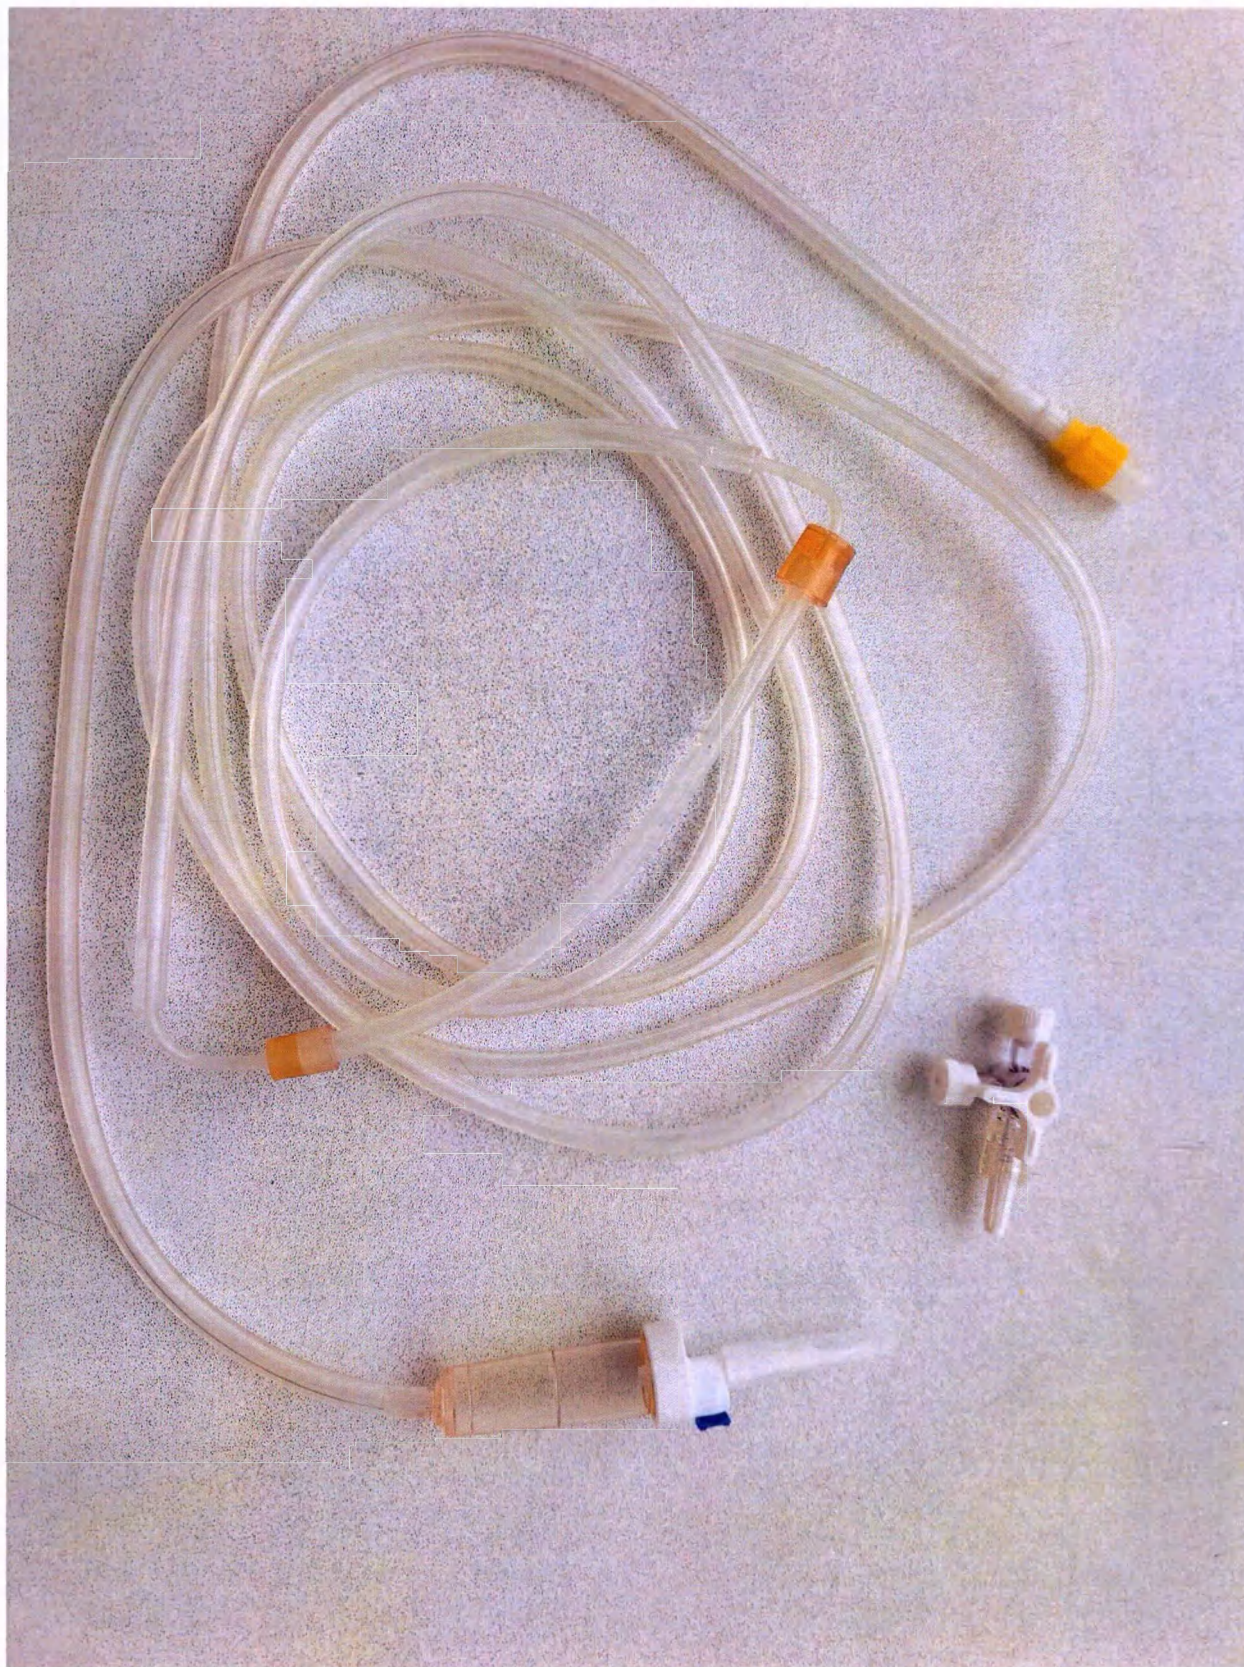

Набор ирригационных трубок «Синтеза Х» для электрофизиологических
процедур в кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Капельница

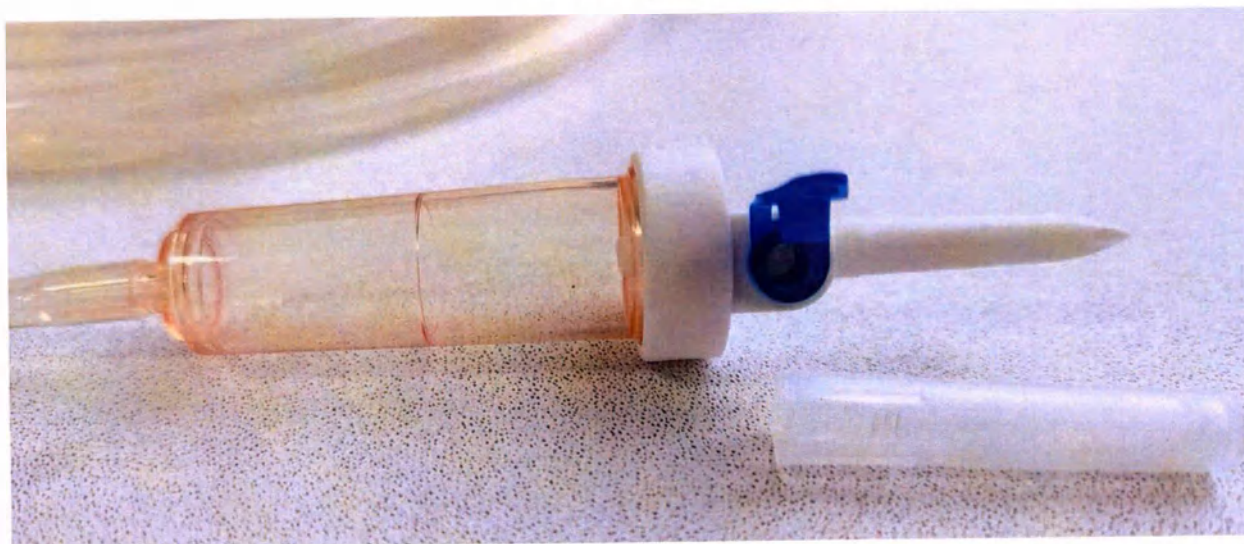


Набор ирригационных трубок «Синтеза Х» для электрофизиологических
процедур в кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Насосный сегмент




Набор ирригационных трубок «Синтеза» для электрофизиологических процедур в
кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Индивидуальная упаковка

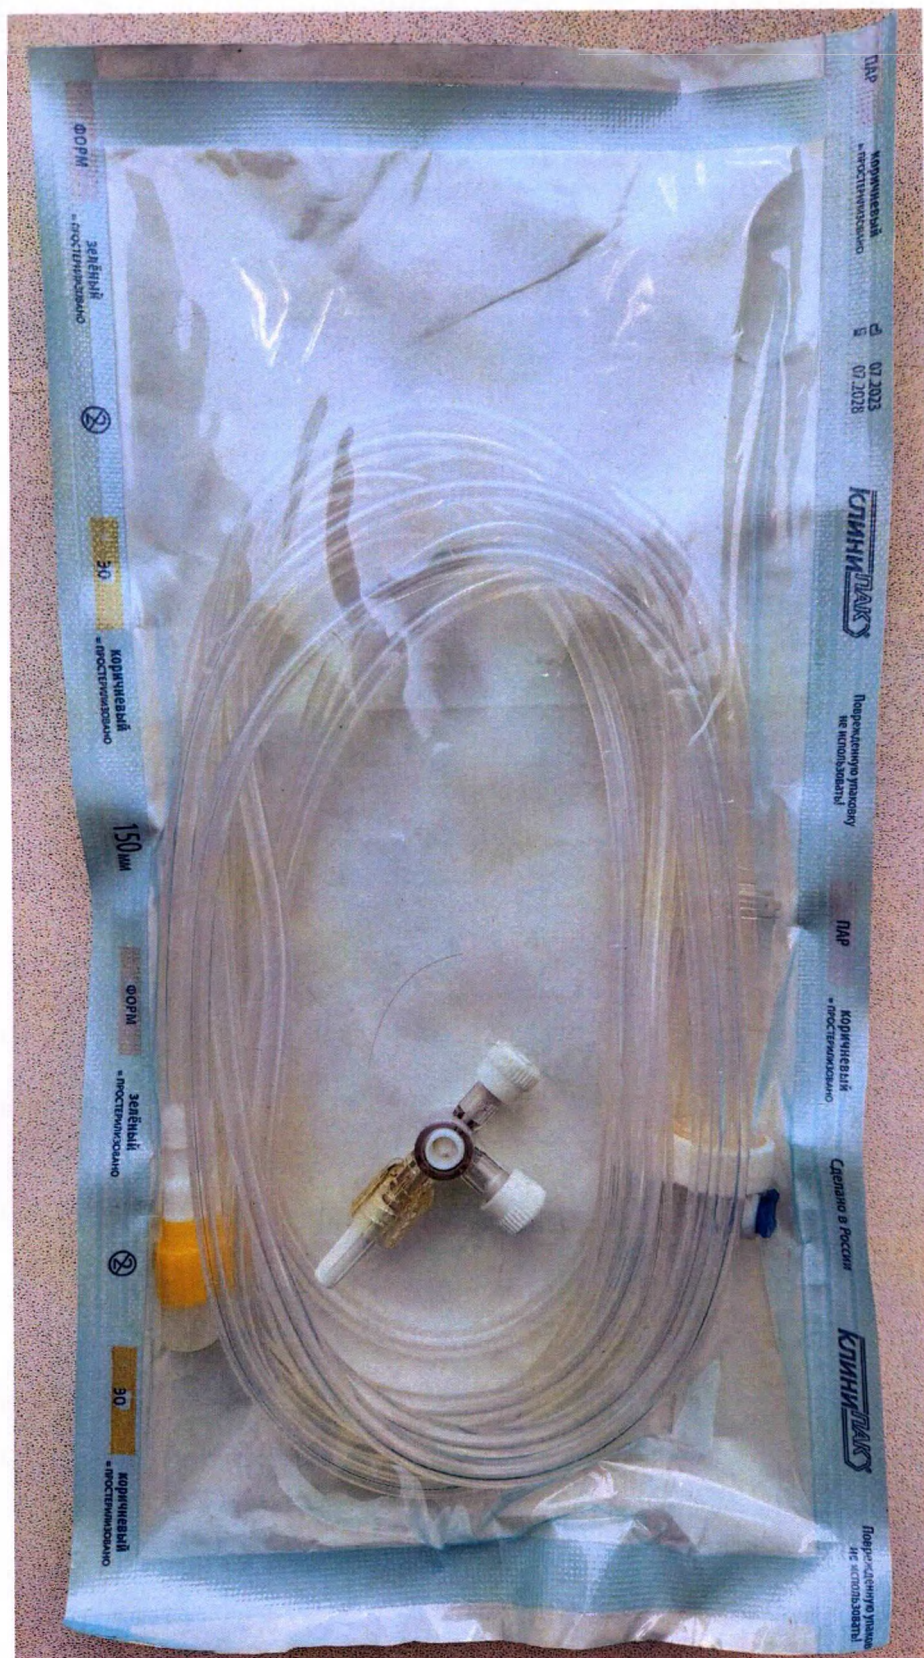


Набор ирригационных трубок «Синтеза» для электрофизиологических процедур в кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Маркировка индивидуальной упаковки

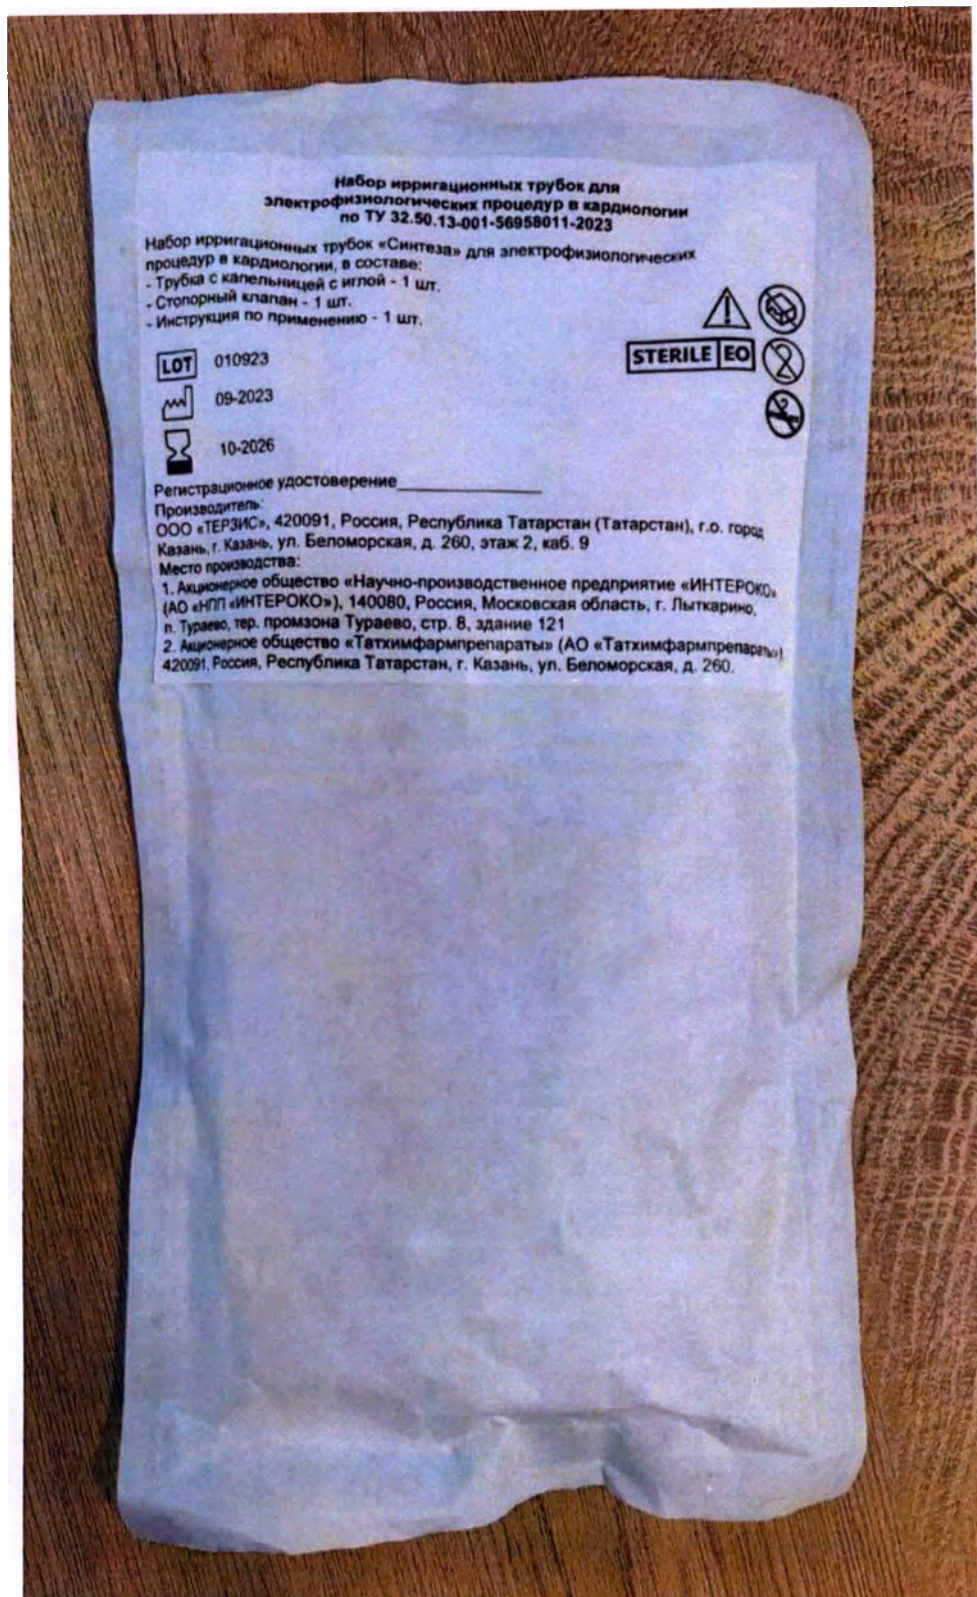


Набор ирригационных трубок «Синтеза» для электрофизиологических процедур в кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

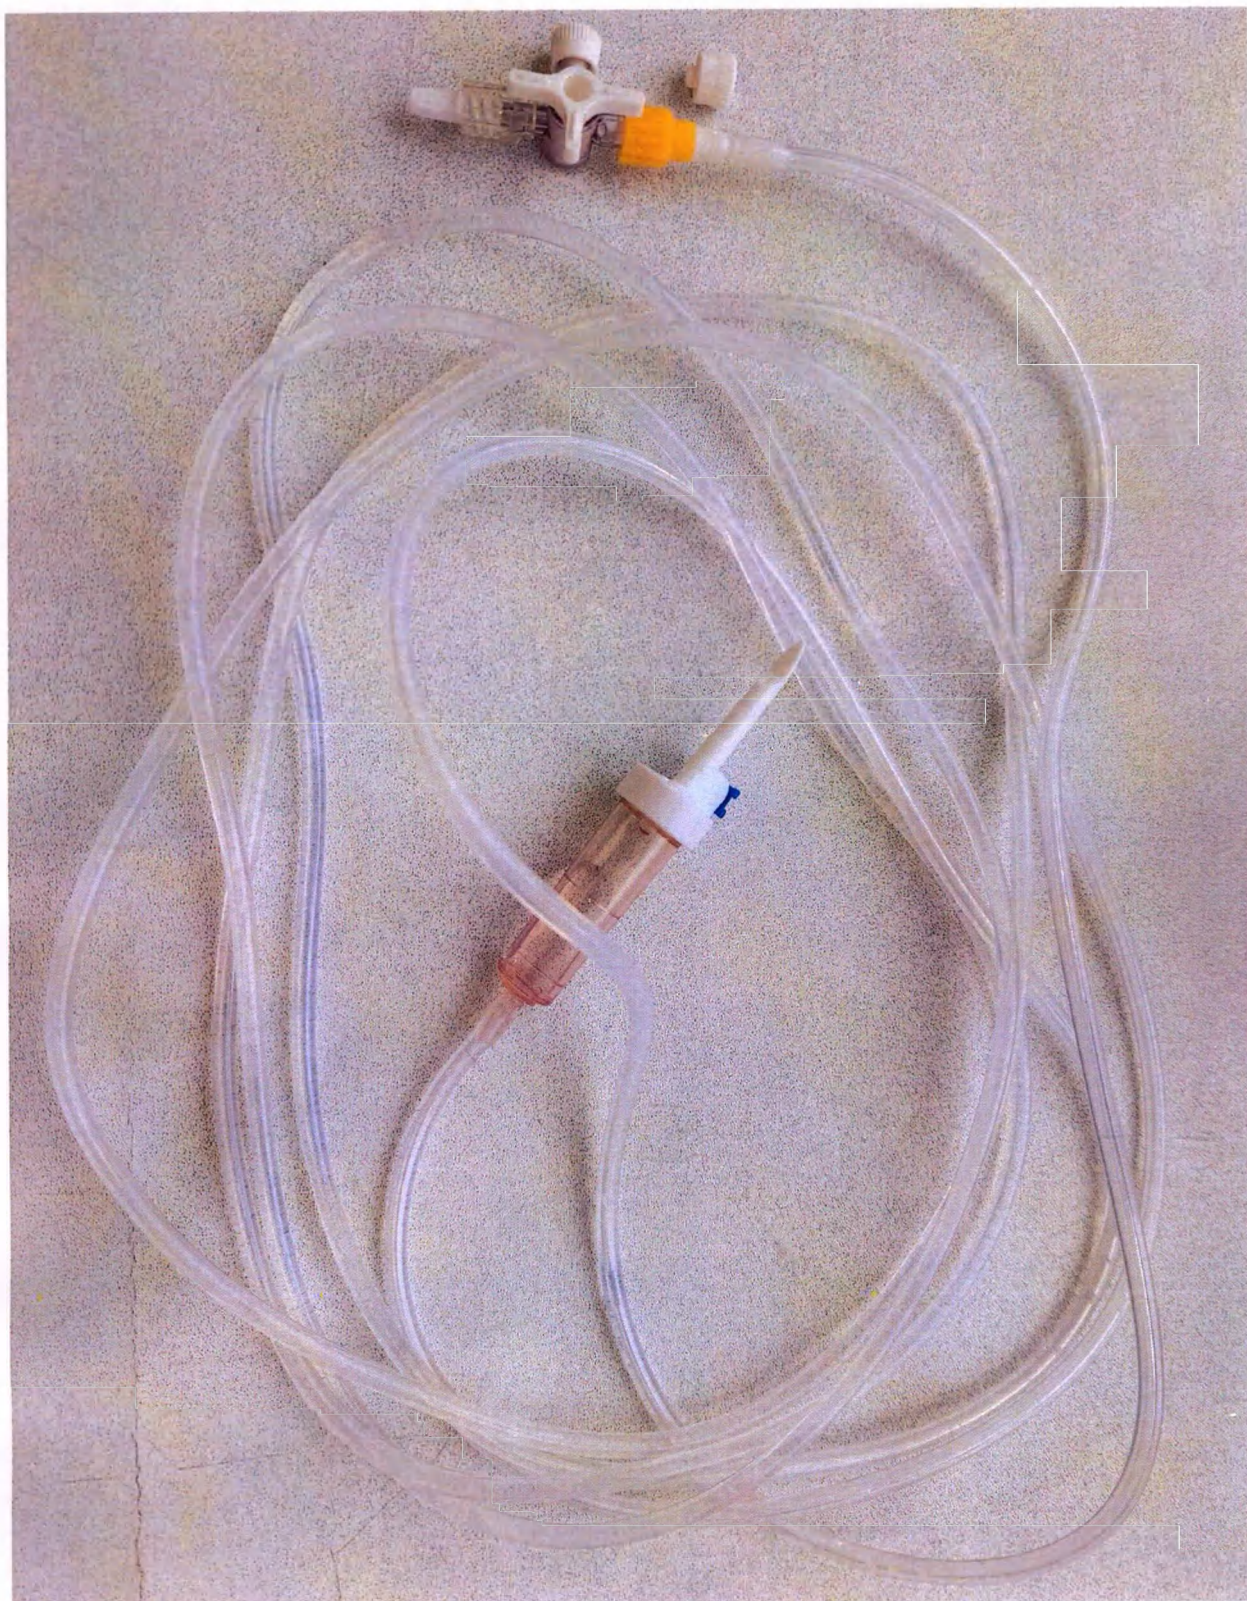


Набор ирригационных трубок «Синтеза» для электрофизиологических процедур в
кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Капельница

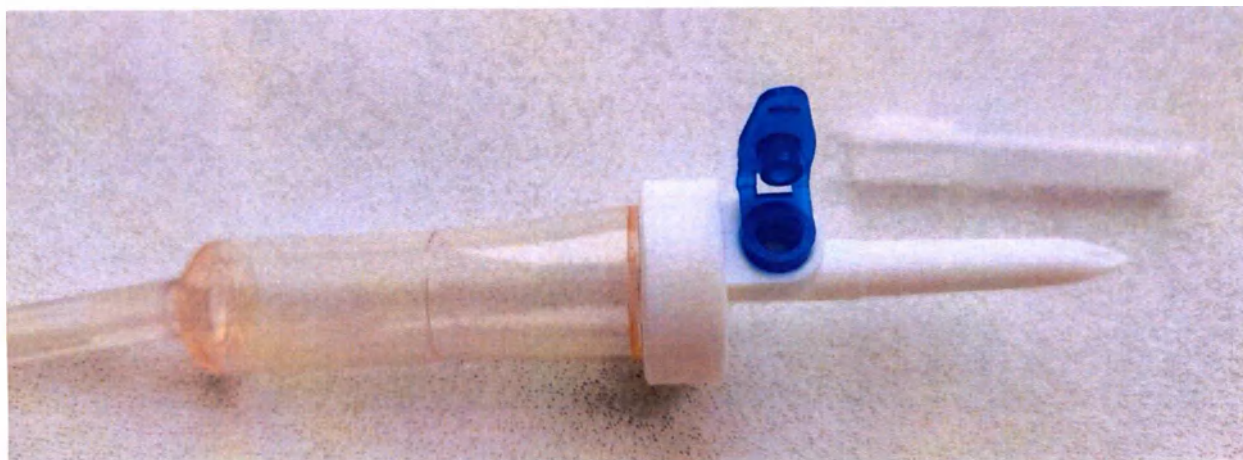


Набор ирригационных трубок «Синтеза» для электрофизиологических процедур в
кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Стопорный клапан

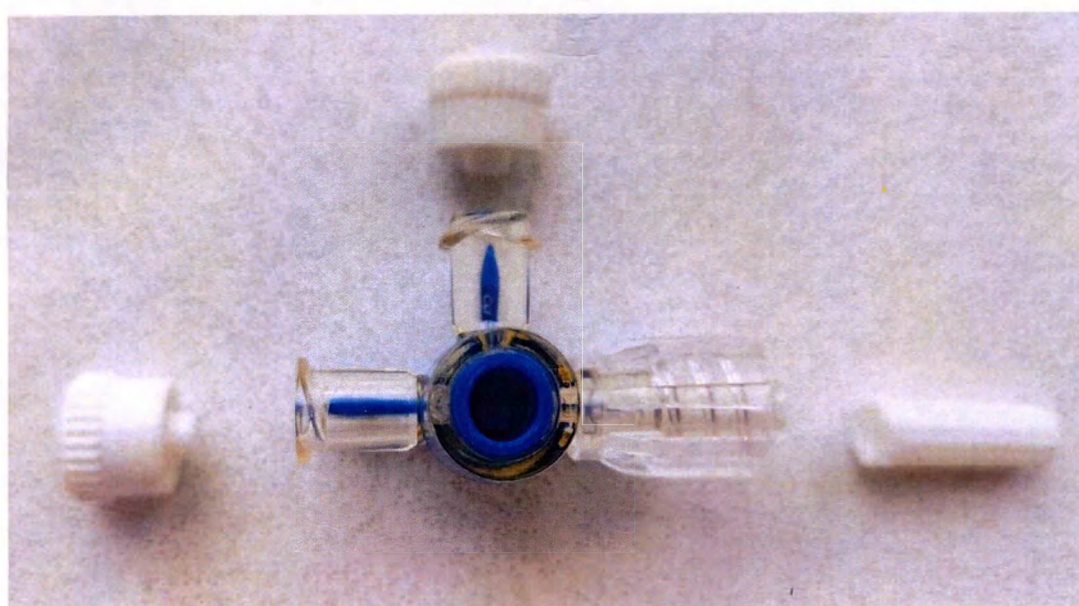

Набор ирригационных трубок «Синтеза» для электрофизиологических процедур в кардиологии ТУ 32.50.13-001-56958011-2023

Коннектор Male Luer Lock с пробкой

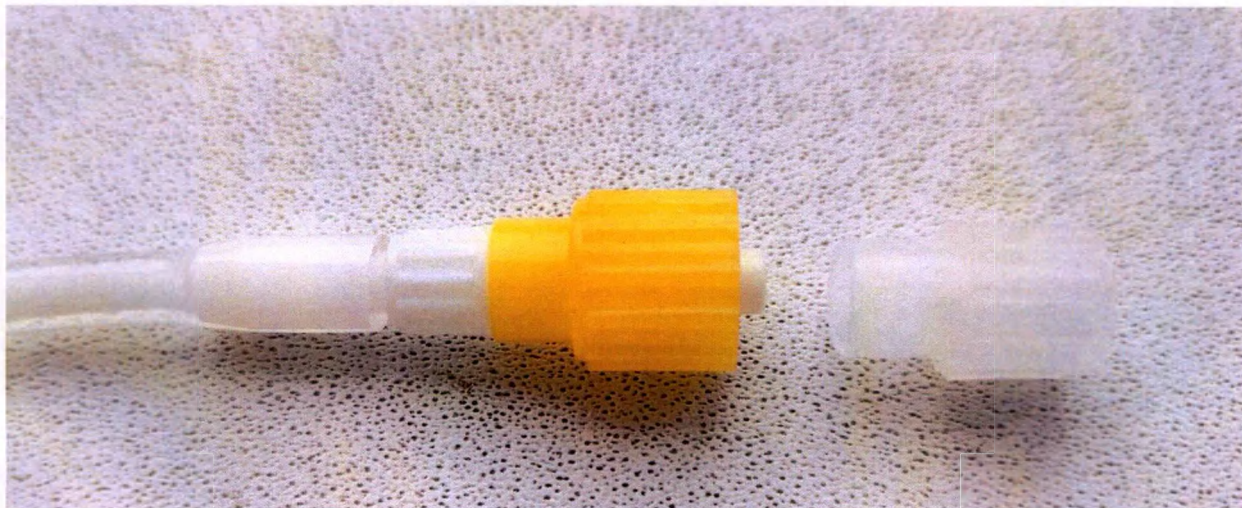

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 16 (шестнадцать) листов
Должность Генеральный директор
Подпись [подпись] Бариев

