

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие:

«Монитор фетальный ВТ-350»



Монитор фетальный BT-350L (вид сверху)



Монитор фетальный BT-350 (вид сверху)




Монитор фетальный BT-350L/BT-350 (индивидуальная упаковка(zip-пакет))



Монитор фетальный BT-350L/BT-350 (вид спереди)




Монитор фетальный BT-350L (вид слева)

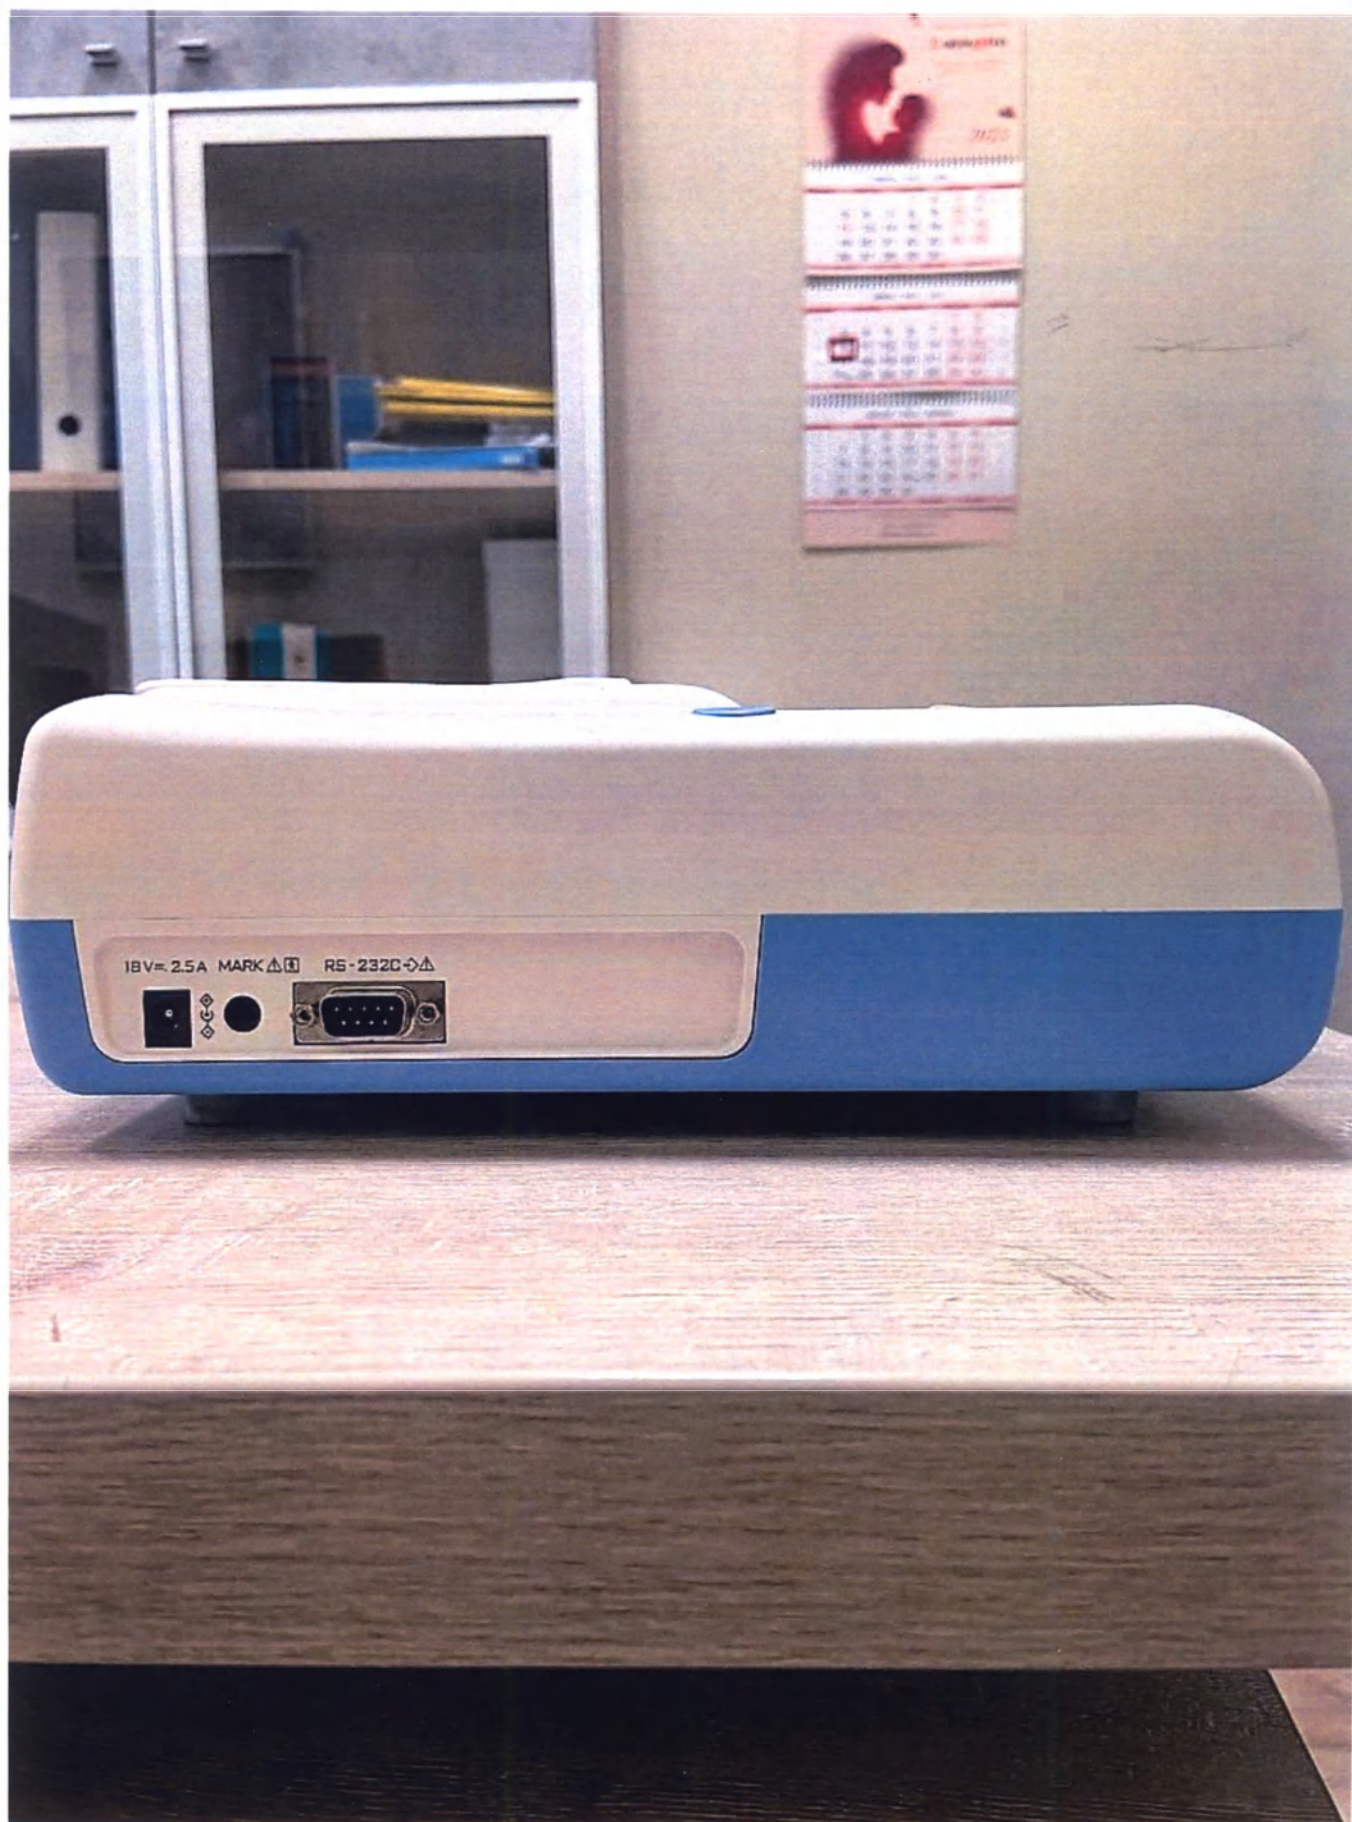

Монитор фетальный VT-350 (вид слева)



Монитор фетальный BT-350L/BT-350 (вид справа)

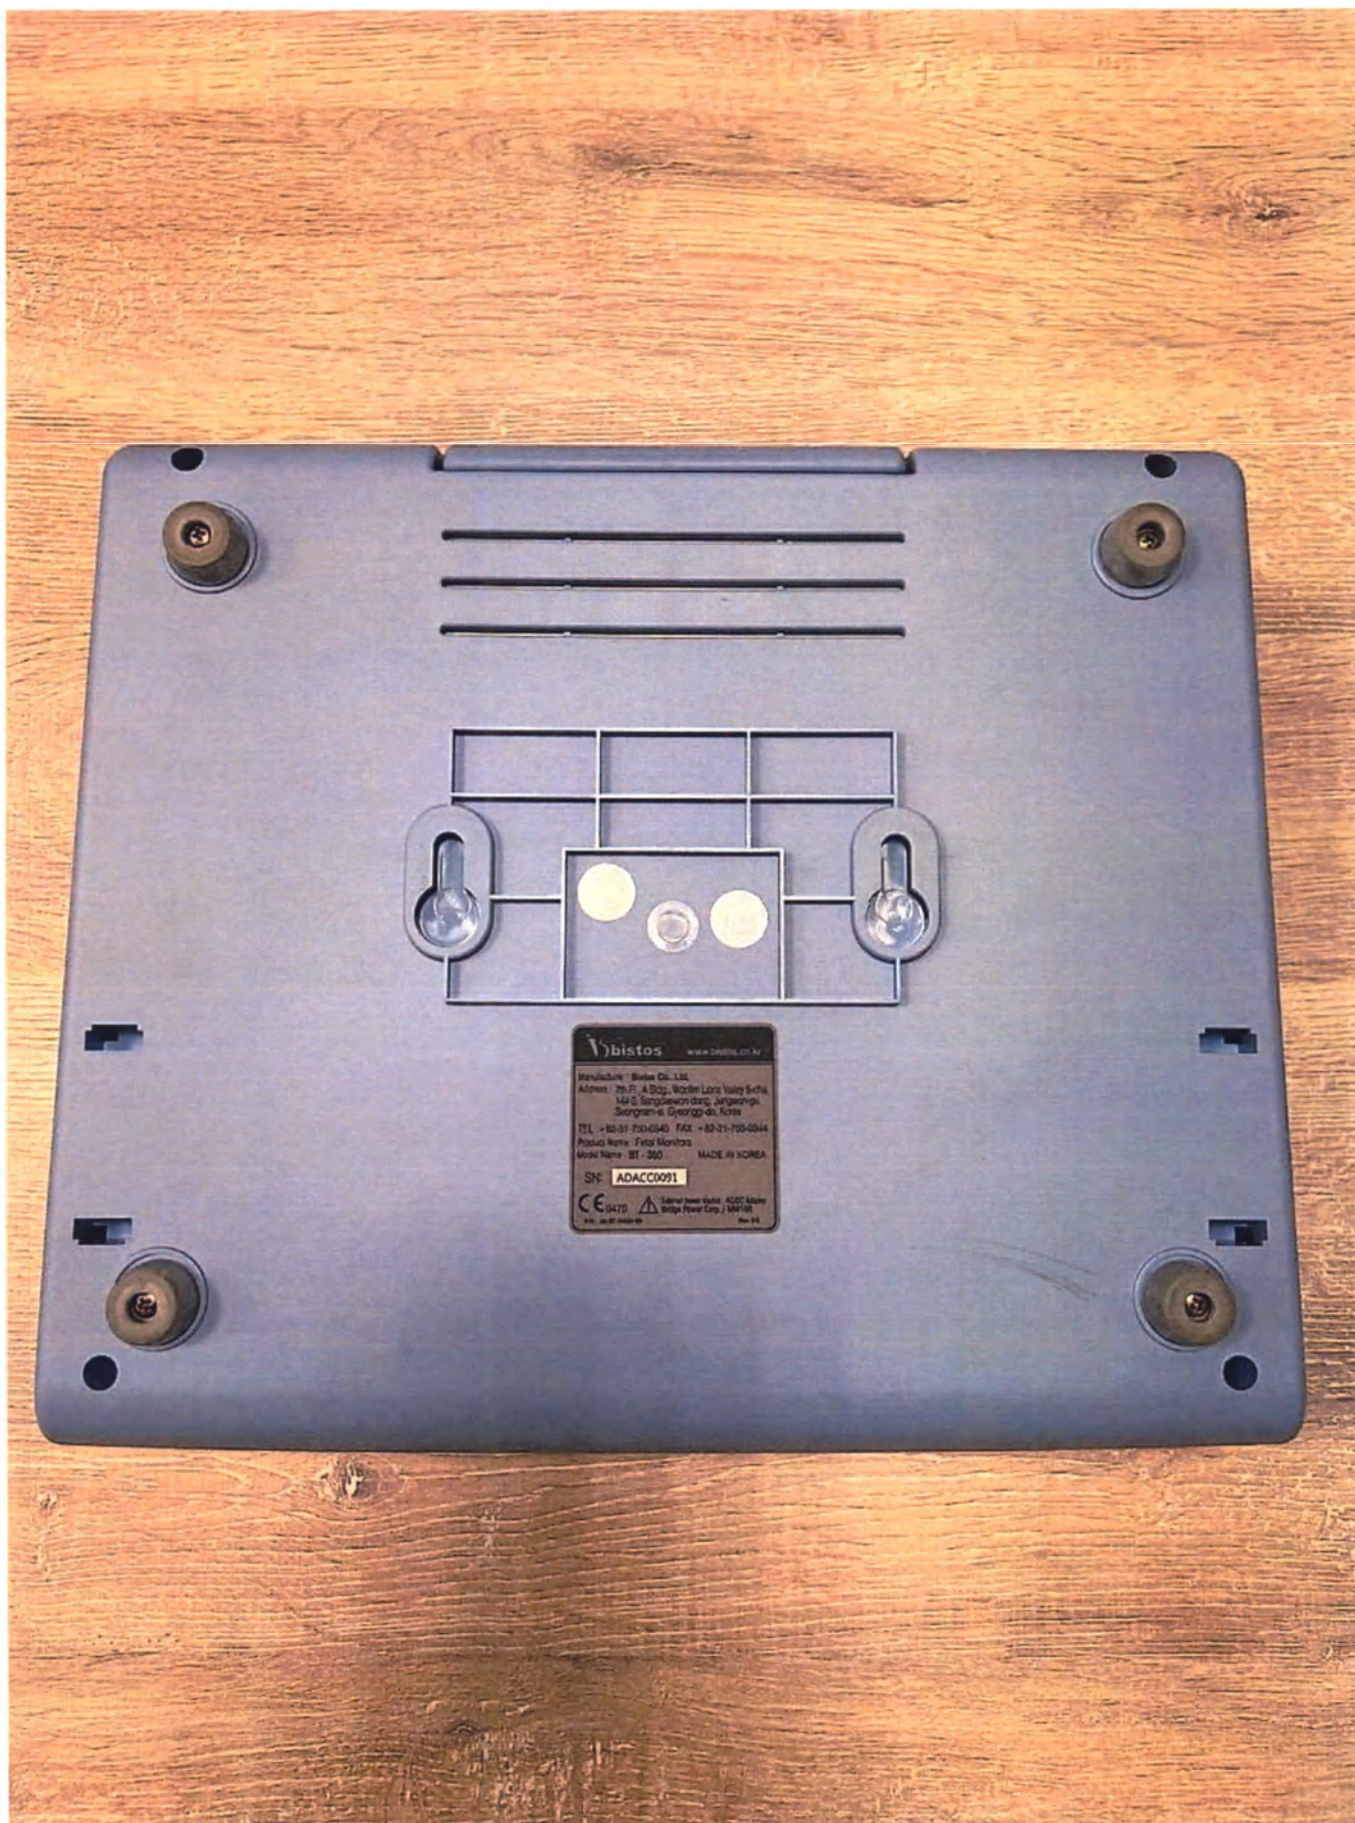

Монитор фетальный BT-350L/BT-350 (вид снизу)



AC DC ADAPTER

MODEL:ZH60DU-1800280
(ZF120A-1802800)

INPUT:AC100-240V~, 2.0A
50/60Hz

OUTPUT:18V --- 2.8A

EFFICIENCY LEVEL: (VI)

CAUTION!  LPS

Do not Remove This Cover.
For Indoor Use Only.



LISTED
E584317

CLASS 2 POWER SUPPLY



Tested to comply with
FCC standard.



SHENZHEN ZHENHUA ELECTRONIC CO., LTD.
MADE IN CHINA

Адаптер питания



Кабель переменного тока



Ремень для удержания зондов



Доплеровский зонд



Зонд маточных сокращений



Маркер событий

FS152-90-80R-01

FS152-90-80R-01

bistos

FHR 240 bpm

FHR 240 bpm

210

210

180

180

150

150

120

120

90

90

60

60

30

30

12

10

8

6

4

2

0 kPa

100

75

50

25

UA 0 mmHg

12

10

8

6

4

2

0 kPa

100

75

50

25

UA 0 mmHg

BISTOS CO., LTD.


BISTOS CO., LTD.

Бумага для печати Z-образная



Гель для ультразвуковых исследований


Монитор фетальный ВТ-350 Руководство по эксплуатации

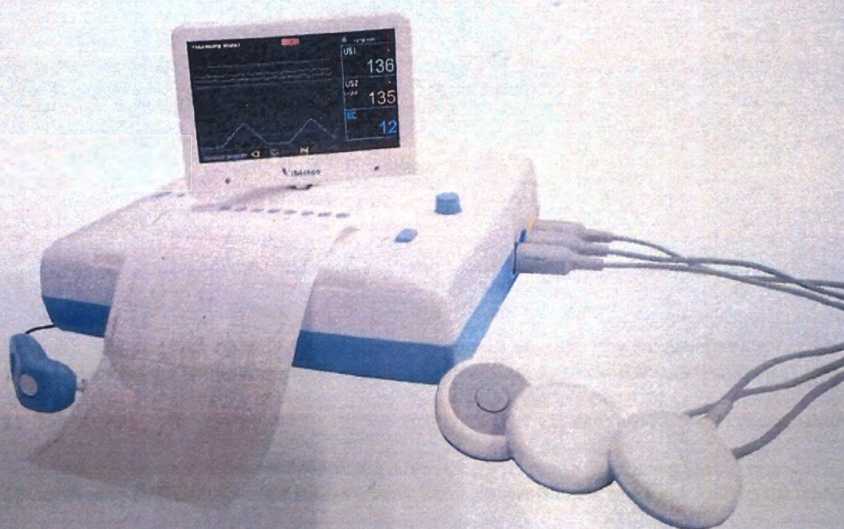

Сохраните это руководство для использования в будущем.

Версия 1.0
Дата последней редакции ноябрь 2023

Руководство по эксплуатации медицинского изделия

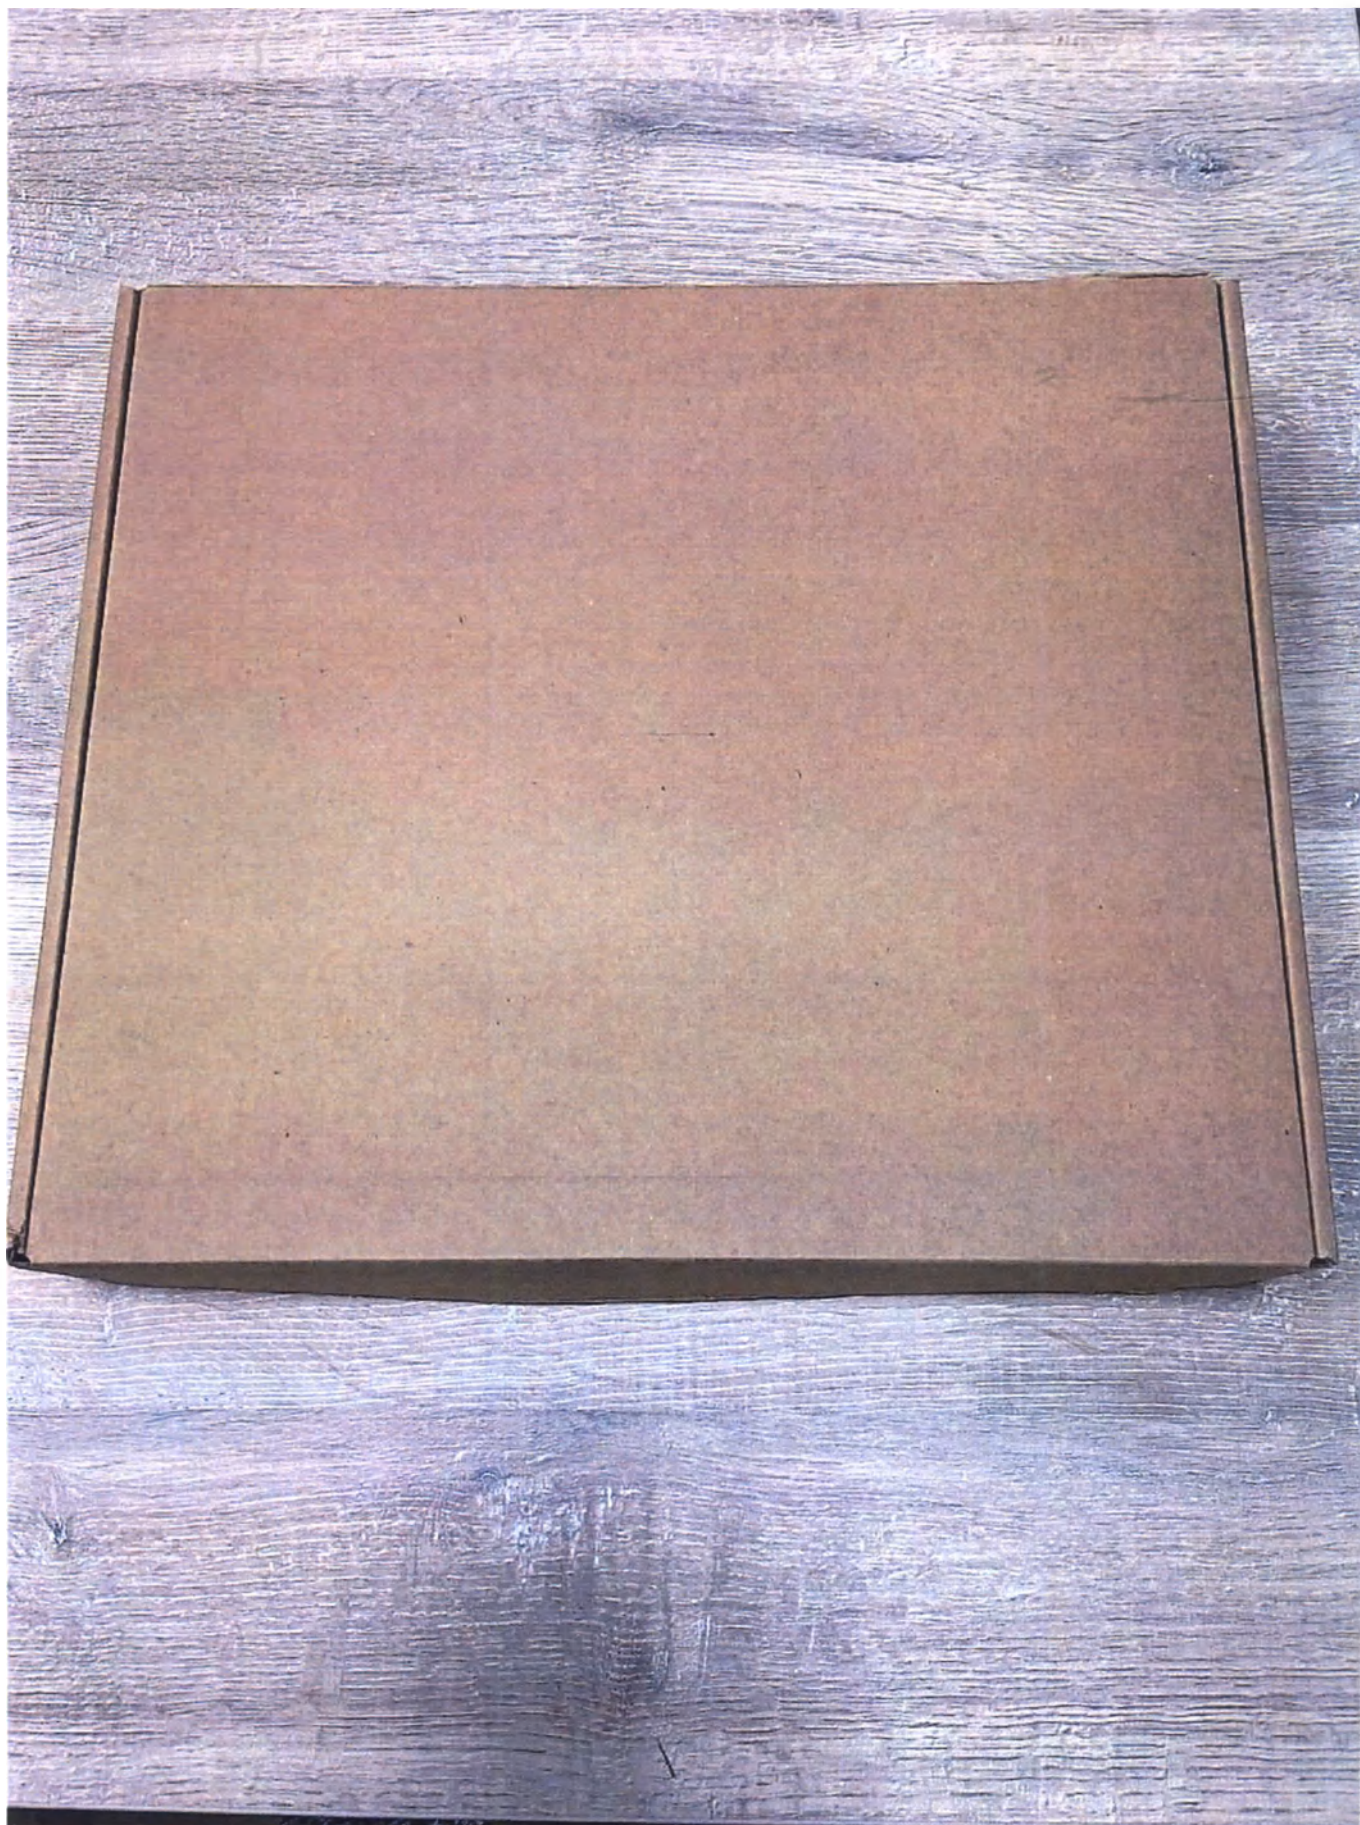

Групповая упаковка для комплектующих (доплеровских зондов, зонда маточных сокращений, геля для ультразвуковых исследований, Z-образной бумаги для печати, зонда AST, маркера событий, адаптера питания, кабеля переменного тока)



Потребительская упаковка медицинского изделия

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРАВАНО
20 ЛИСТОВ

ГЕН. ДИРЕКТОР
КУЗНЕЦОВА Д.В.

