


УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

ПАО «Техприбор»

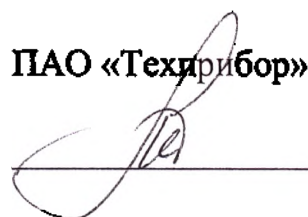

А.Ю. Новиков

« 05 » 12 2023 г.

Фотографические изображения

**«Аппарат искусственной неинвазивной вентиляции легких для
новорожденных НЕОЛАЙН-1»**

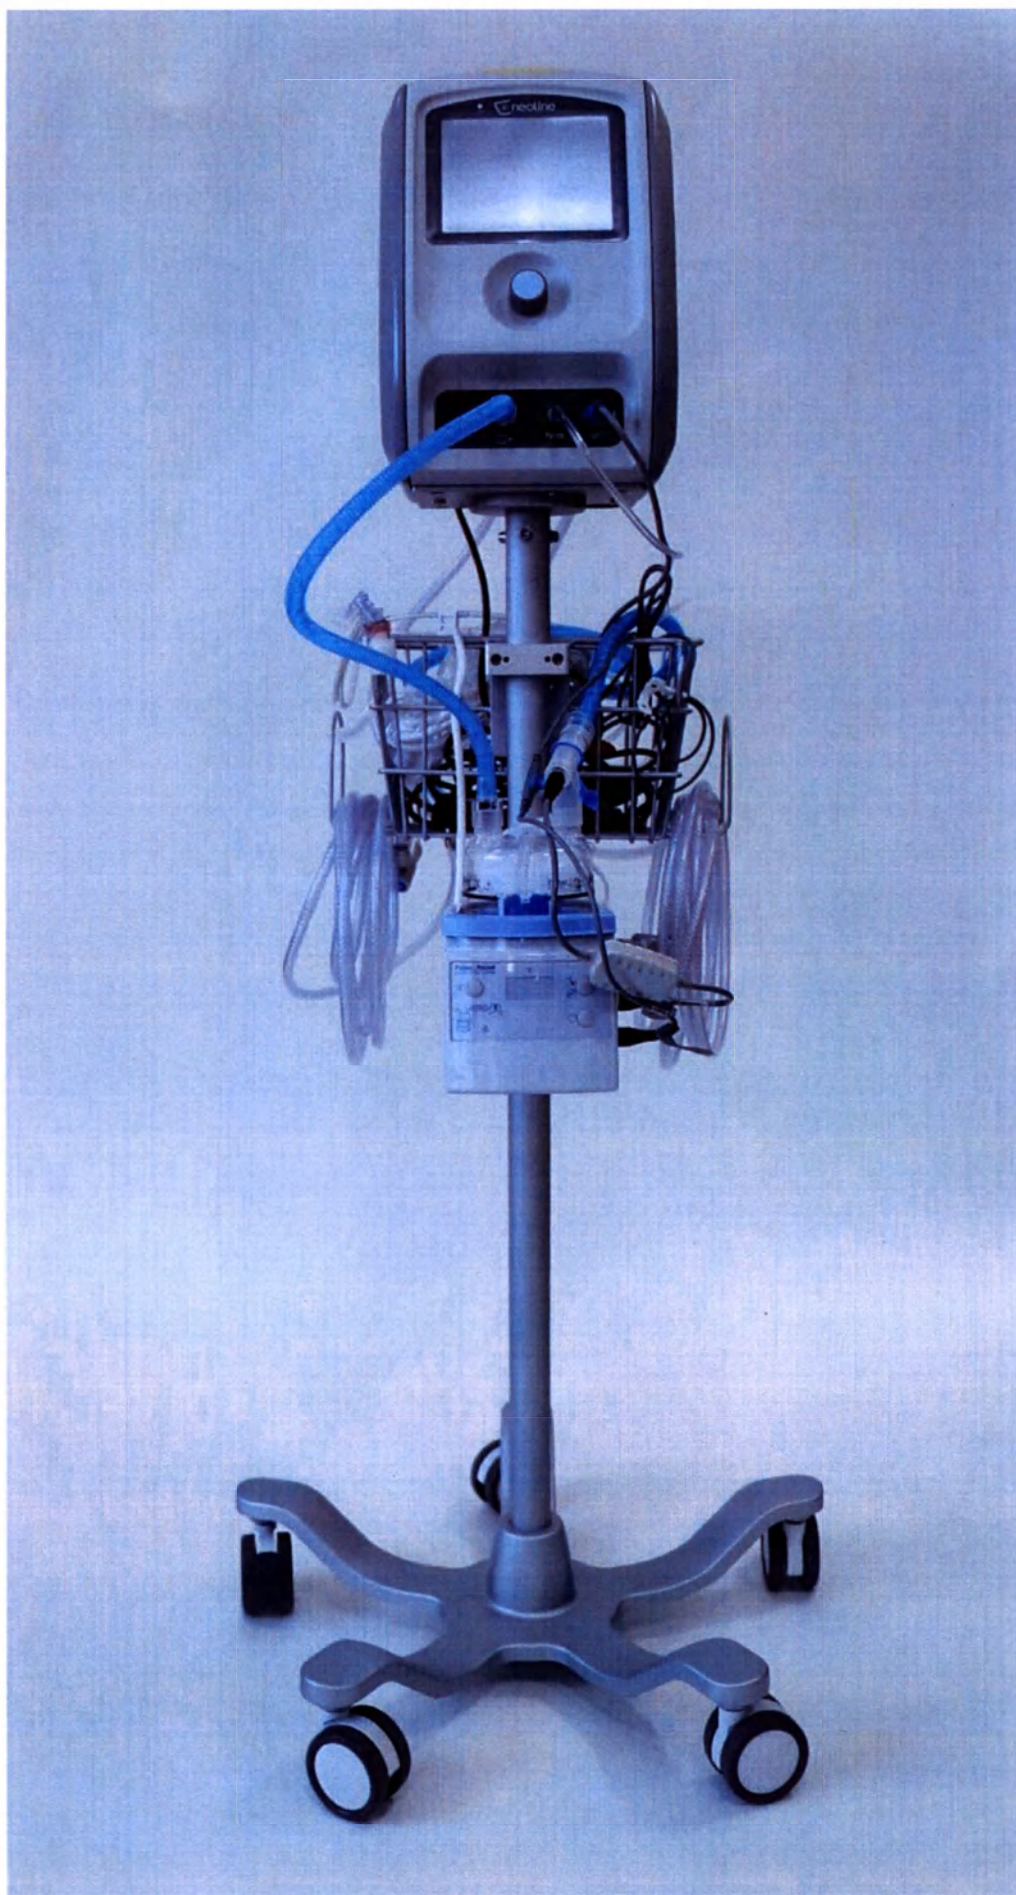


Рисунок 1 – Аппарат искусственной неинвазивной вентиляции легких для новорожденных НЕОЛАЙН-1 (общий вид спереди)

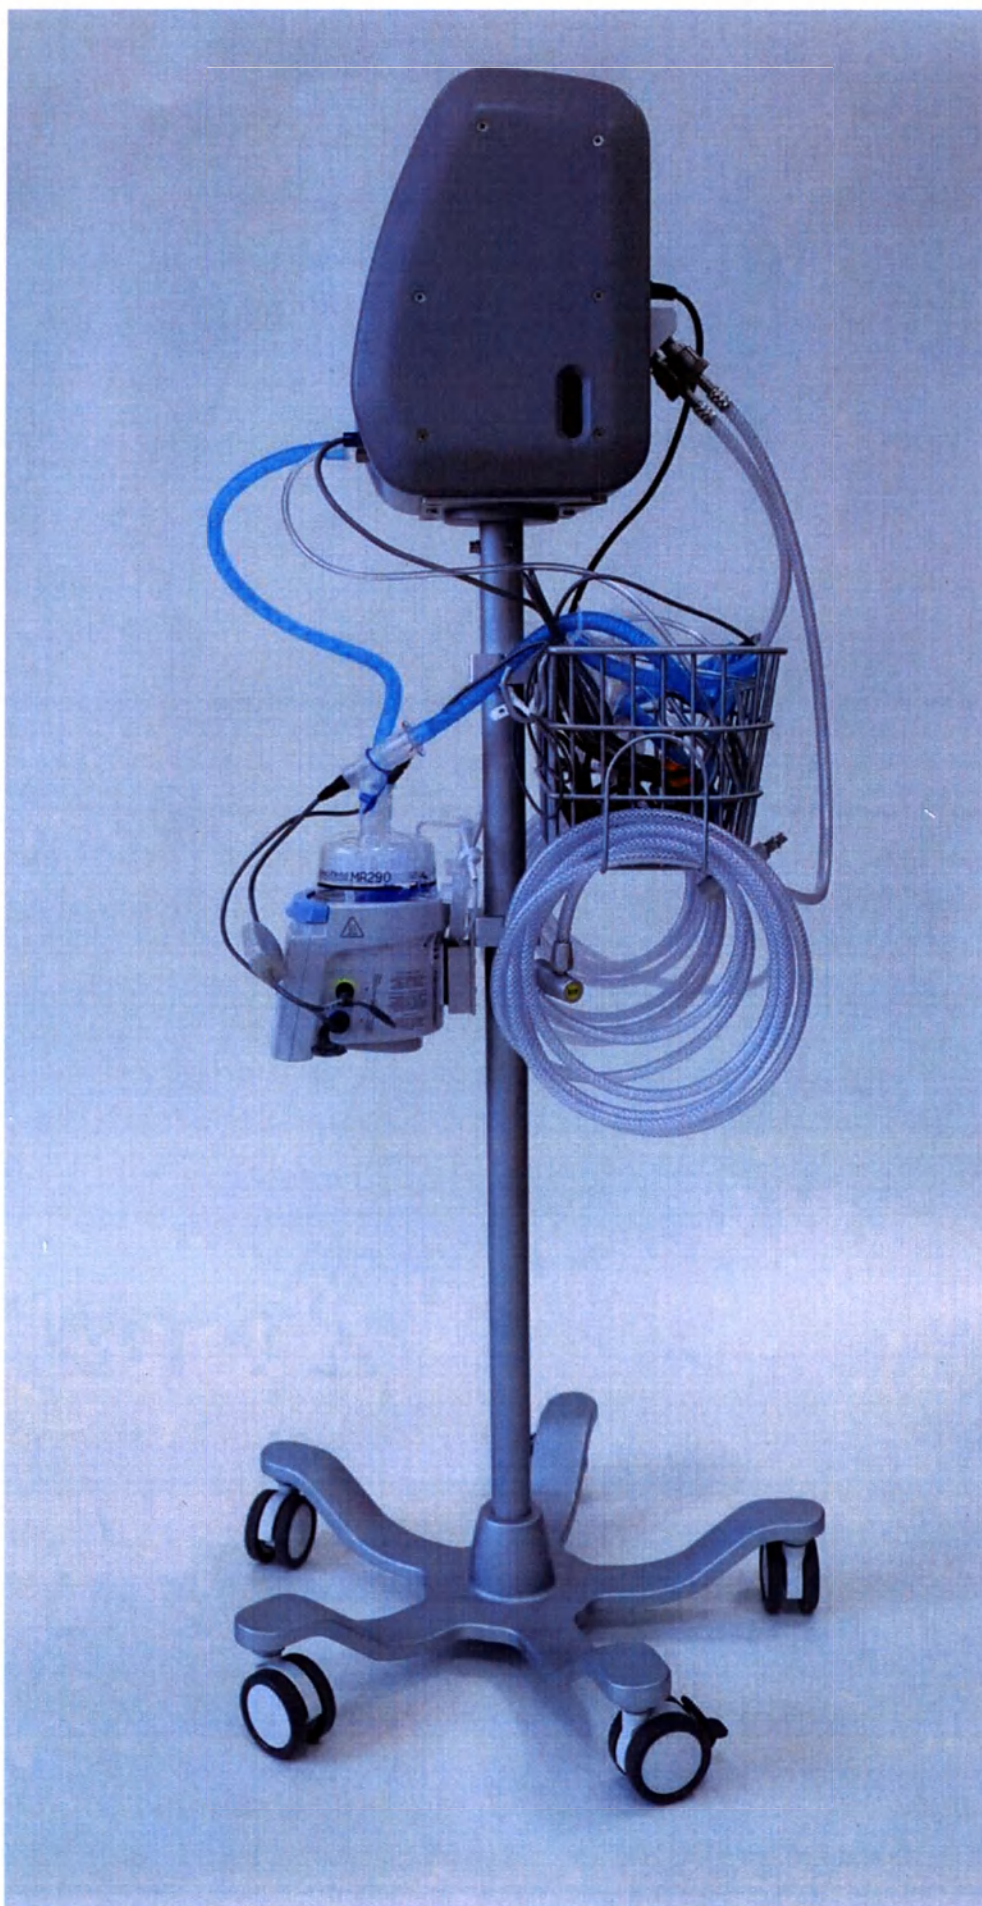


Рисунок 2 – Аппарат искусственной неинвазивной вентиляции легких для новорожденных НЕОЛАЙН-1 (общий вид справа)

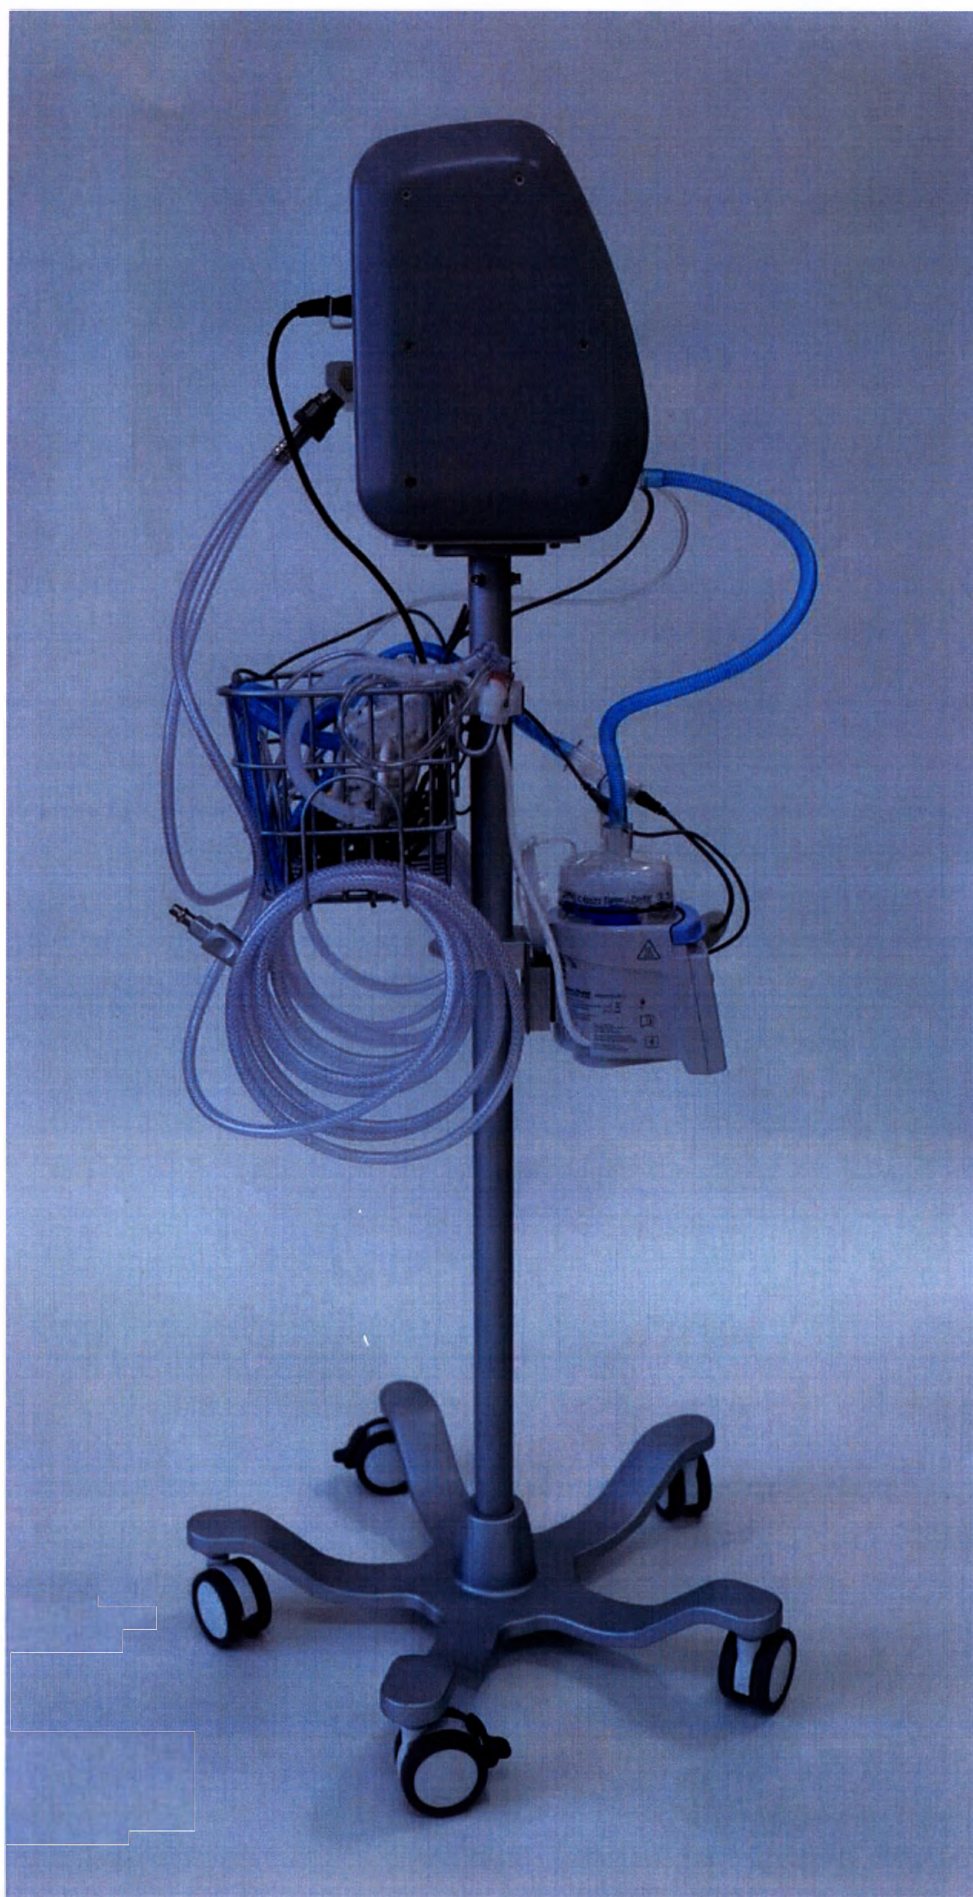


Рисунок 3 – Аппарат искусственной неинвазивной вентиляции легких для новорожденных НЕОЛАЙН-1 (общий вид слева)

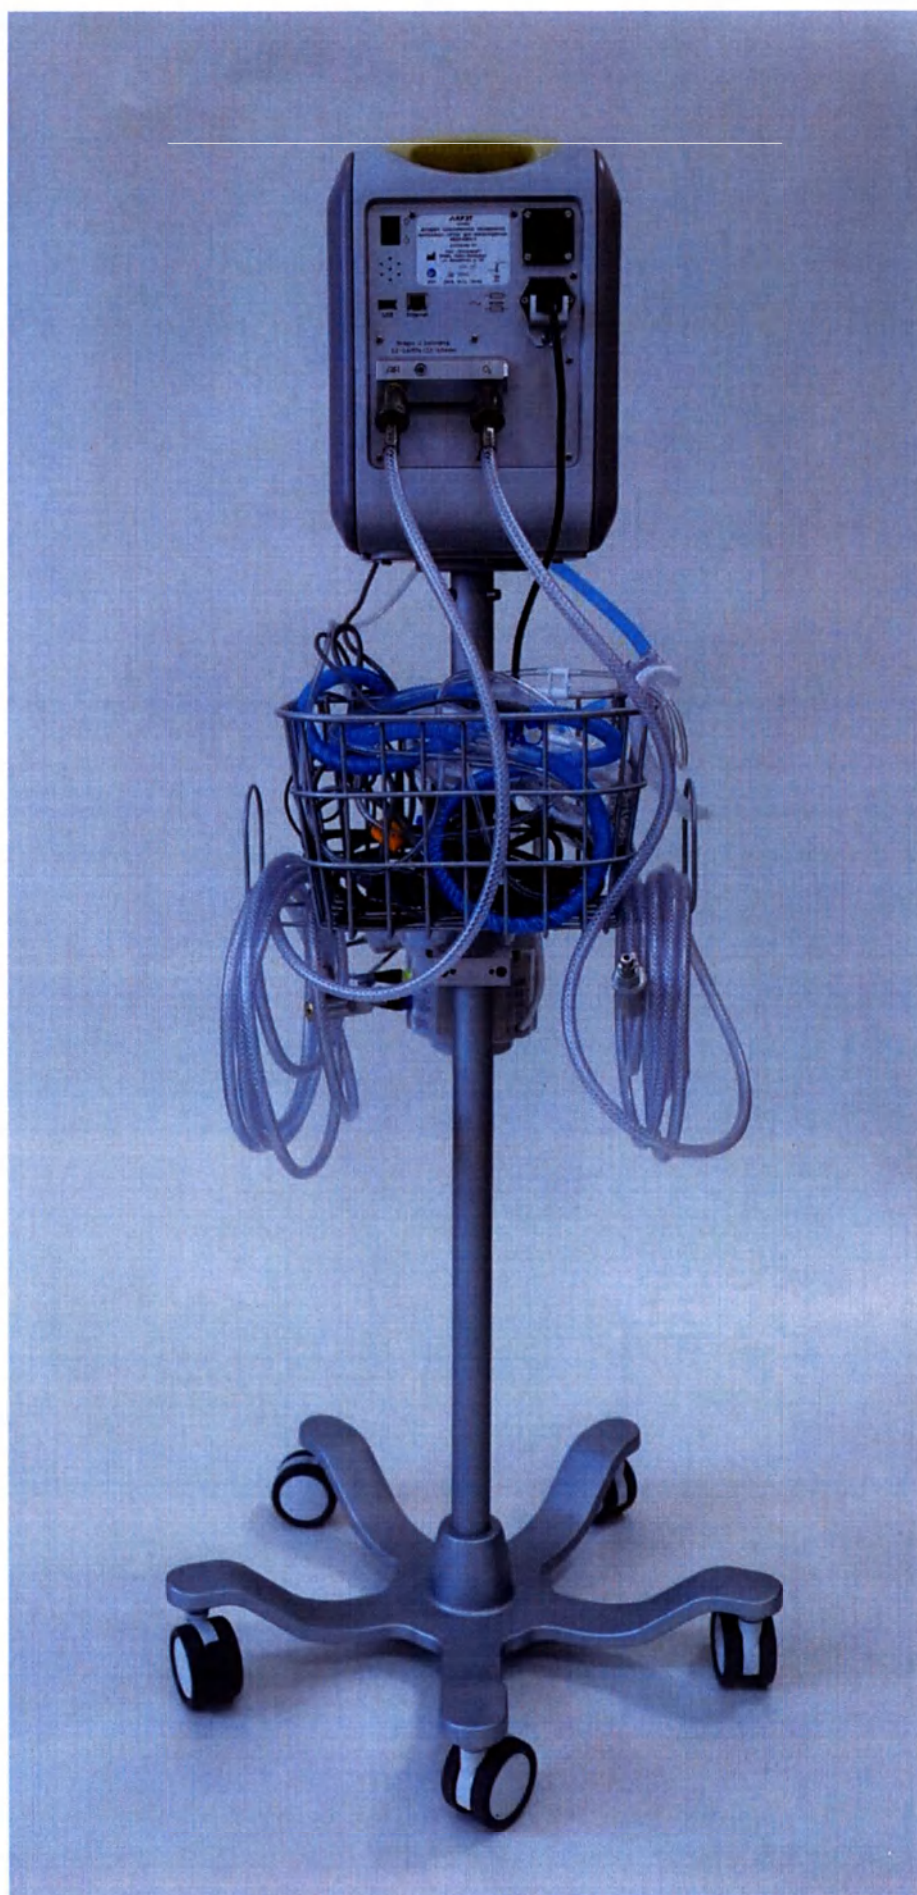


Рисунок 4 – Аппарат искусственной неинвазивной вентиляции легких для новорожденных
НЕОЛАЙН-1 (общий вид сзади)



Рисунок 5 – блок искусственной неинвазивной вентиляции легких БИНВЛ 6Т3.280.001 с предустановленным программным обеспечением 075.12813.00485-01, версии V3.01 (вид спереди)



Рисунок 6 – блок искусственной неинвазивной вентиляции легких БИНВЛ 6Т3.280.001 с предустановленным программным обеспечением 075.12813.00485-01, версии V3.01 (вид сзади)

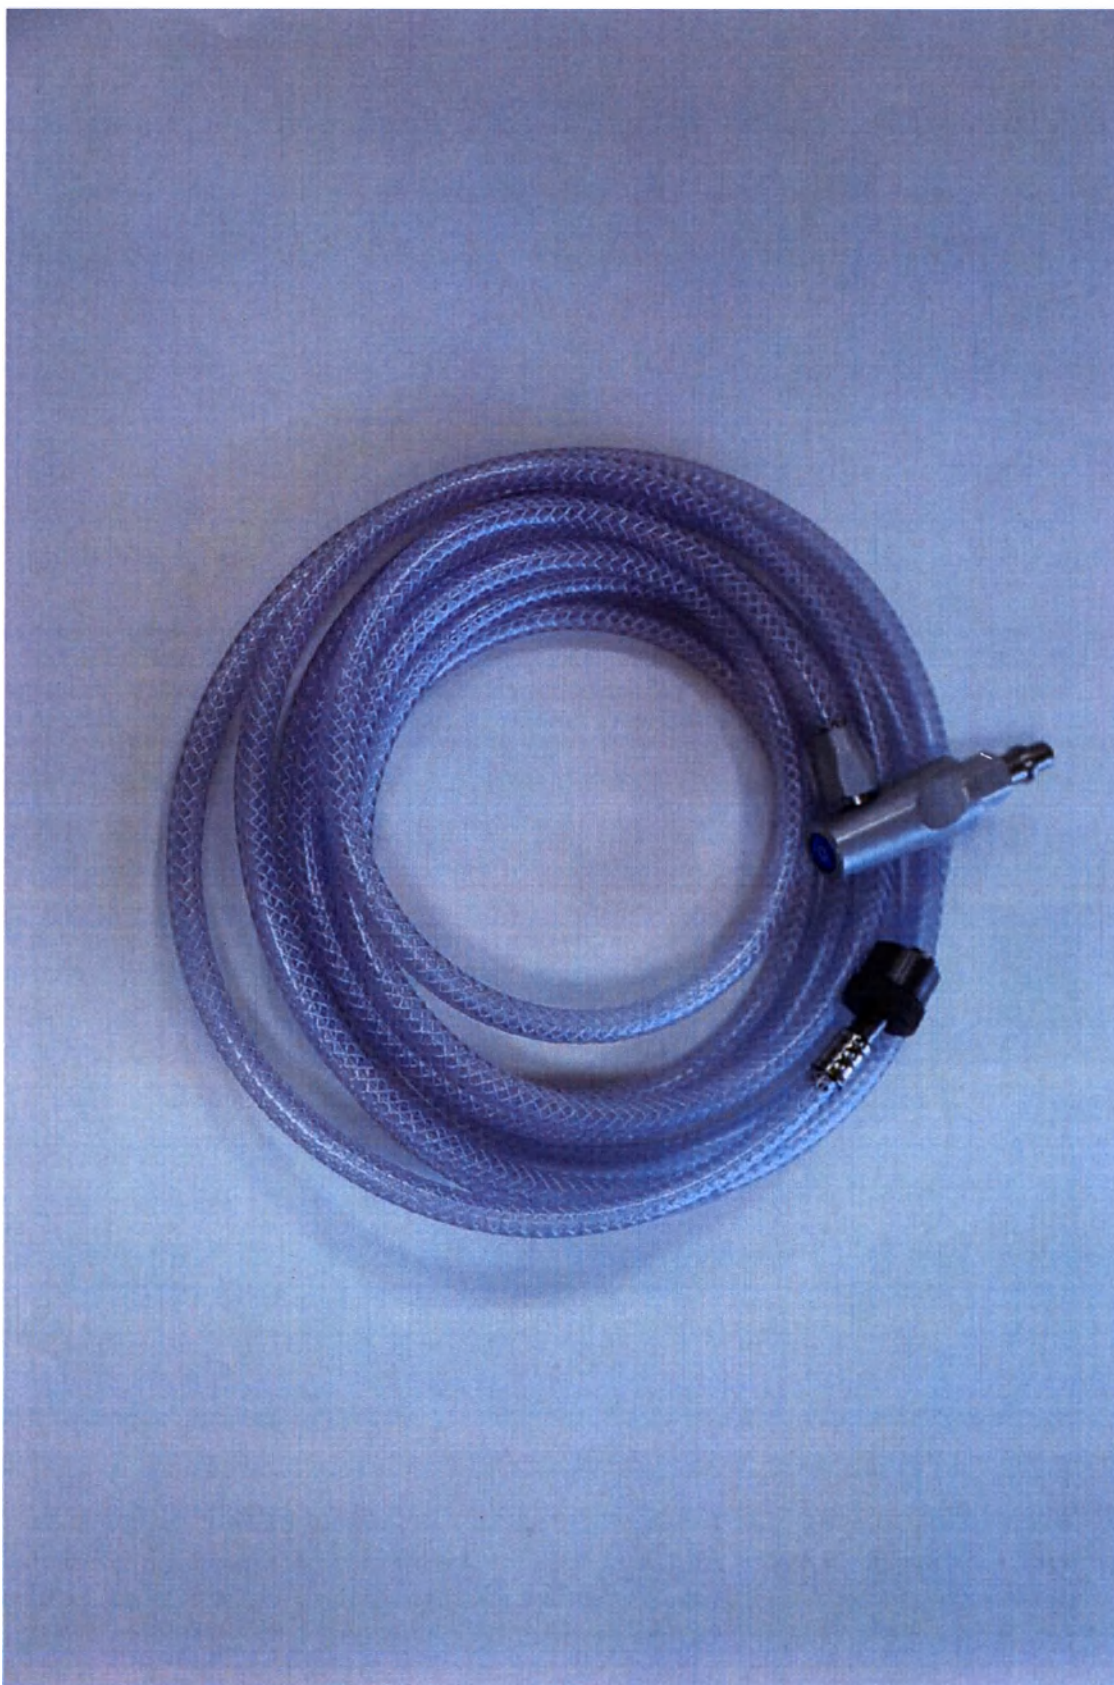


Рисунок 7— шланг подачи кислорода 6Т6.450.006-01

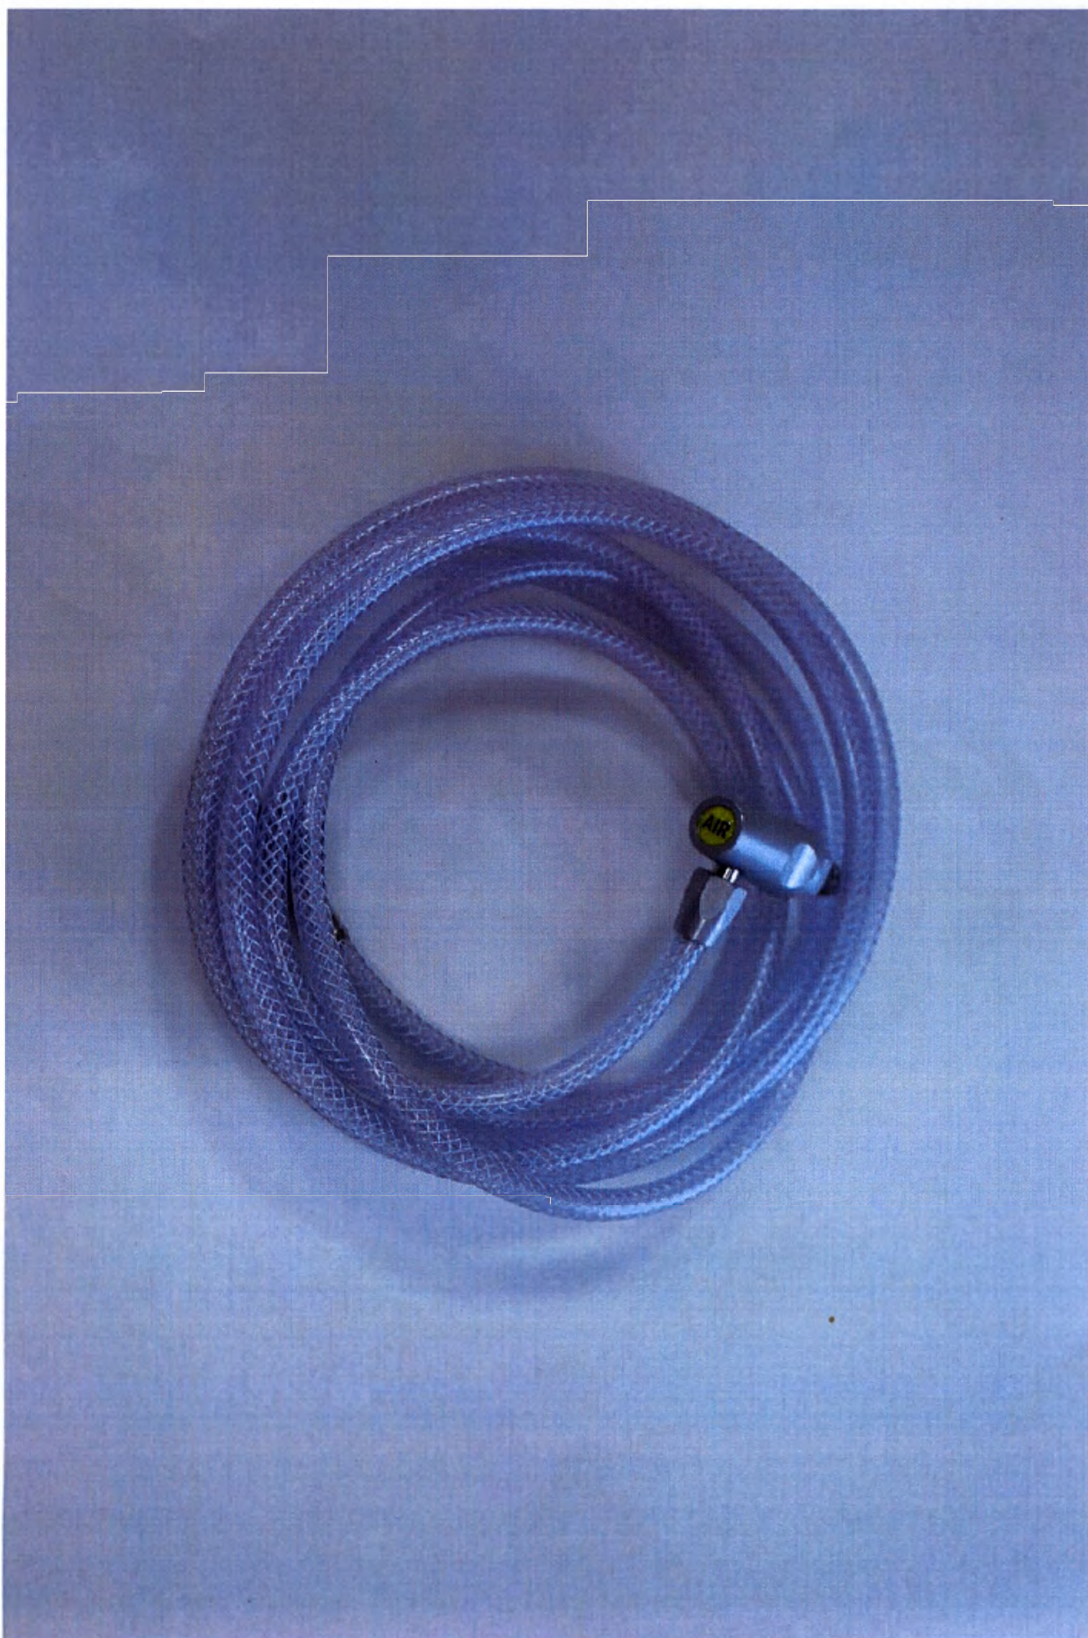


Рисунок 8 – шланг подачи воздуха 6Т6.450.006



Рисунок 9 – шнур сетевой ПВС-АП 3×0,75 S22C13-250-10-3,5



Рисунок 10 – кабель 6Т6.644.842



Рисунок 11 –Аппарат искусственной вентиляции легких Т-образный Neo-Tee с ручным управлением с принадлежностями. Контур пациента, 10-50902 (регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3224 от:26.10.2015)



Рисунок 12 – Датчики пульсоксиметрические Nellcor с принадлежностями. Вариант исполнения: Датчики SpO₂ многоразового и частично многоразового использования (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11628 от 28.12.2018)

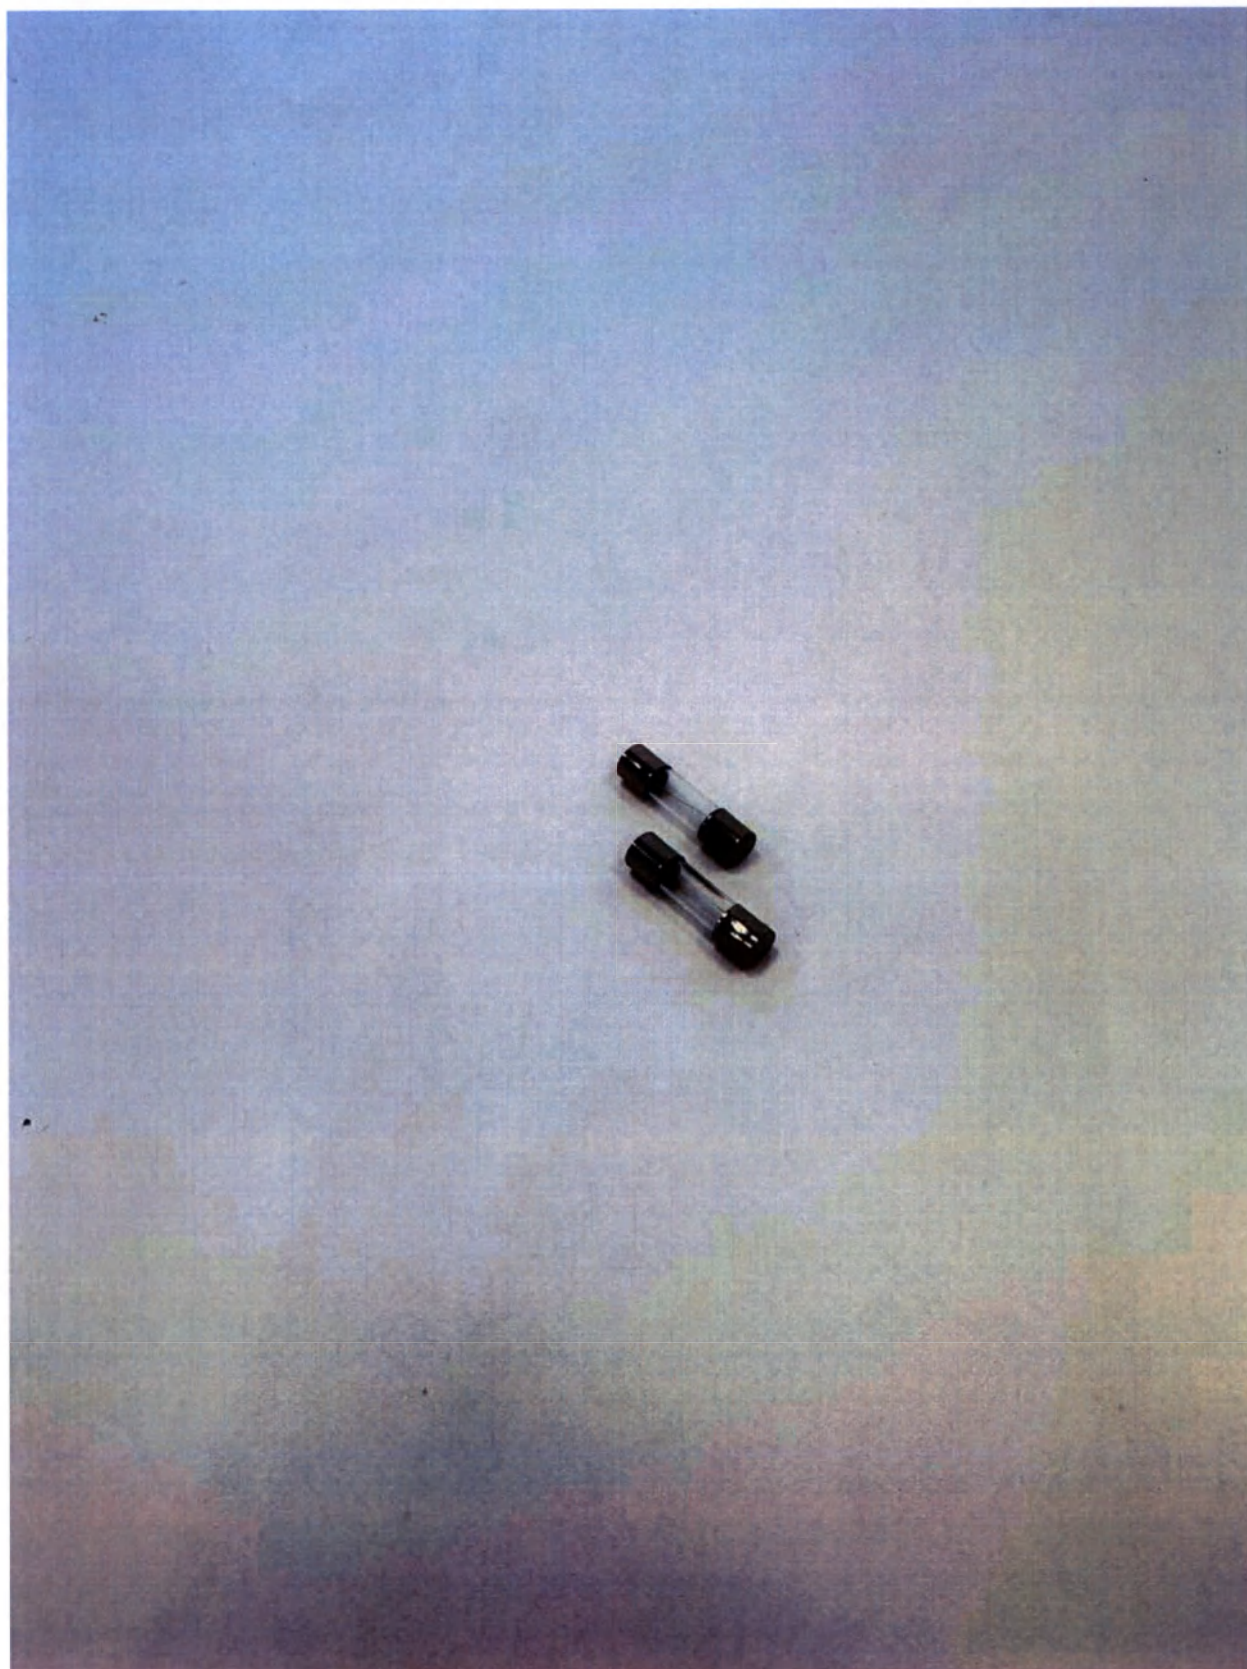


Рисунок 13 – вставка плавкая ВПТ6-10 (2 А / 250 В)-



Рисунок 14 – Увлажнитель дыхательных смесей MR810 с принадлежностями.
Принадлежность: Камера увлажнителя MR290 (регистрационное удостоверение № ФСЗ
2007/00742 от 07.12.2007)



Рисунок 15 – Увлажнитель дыхательных смесей MR850 с принадлежностями. I.
Увлажнитель дыхательных смесей MR850 (регистрационное удостоверение № РЗН
2014/1416 от 28.02.2014)



Рисунок 16 – Увлажнитель дыхательных смесей MR850 с принадлежностями.
Принадлежность: Температурный датчик для увлажнителя, вариант исполнения:
900MR860 (регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1416 от 28.02.2014))



Рисунок 17 – Увлажнитель дыхательных смесей MR850 с принадлежностями.
Принадлежность: Кабель гибкого нагревателя, вариант исполнения: 900MR806
(регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1416 от 28.02.2014)



Рисунок 18 – Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции лёгких для лечения новорожденных. Дыхательный контур пациента, варианты исполнения: Дыхательный контур пациента с генератором дыхания и шумопоглатителем, ИНС4064/N (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10229 от 28.01.2020)



Рисунок 19 – Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции лёгких для лечения новорожденных. Канюли назальные, размер S, VX8021. Канюли назальные, размер M, VX8022 . Канюли назальные, размер L, VX8023 (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10229 от 28.01.2020)



Рисунок 20 – Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции лёгких для лечения новорожденных. Маски лицевые дыхательные, размер S, VX8030. Маски лицевые дыхательные, размер M, VX8031. Маски лицевые дыхательные, размер L, VX8032. Маски лицевые дыхательные, размер XL, VX8033 (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10229 от 28.01.2020)

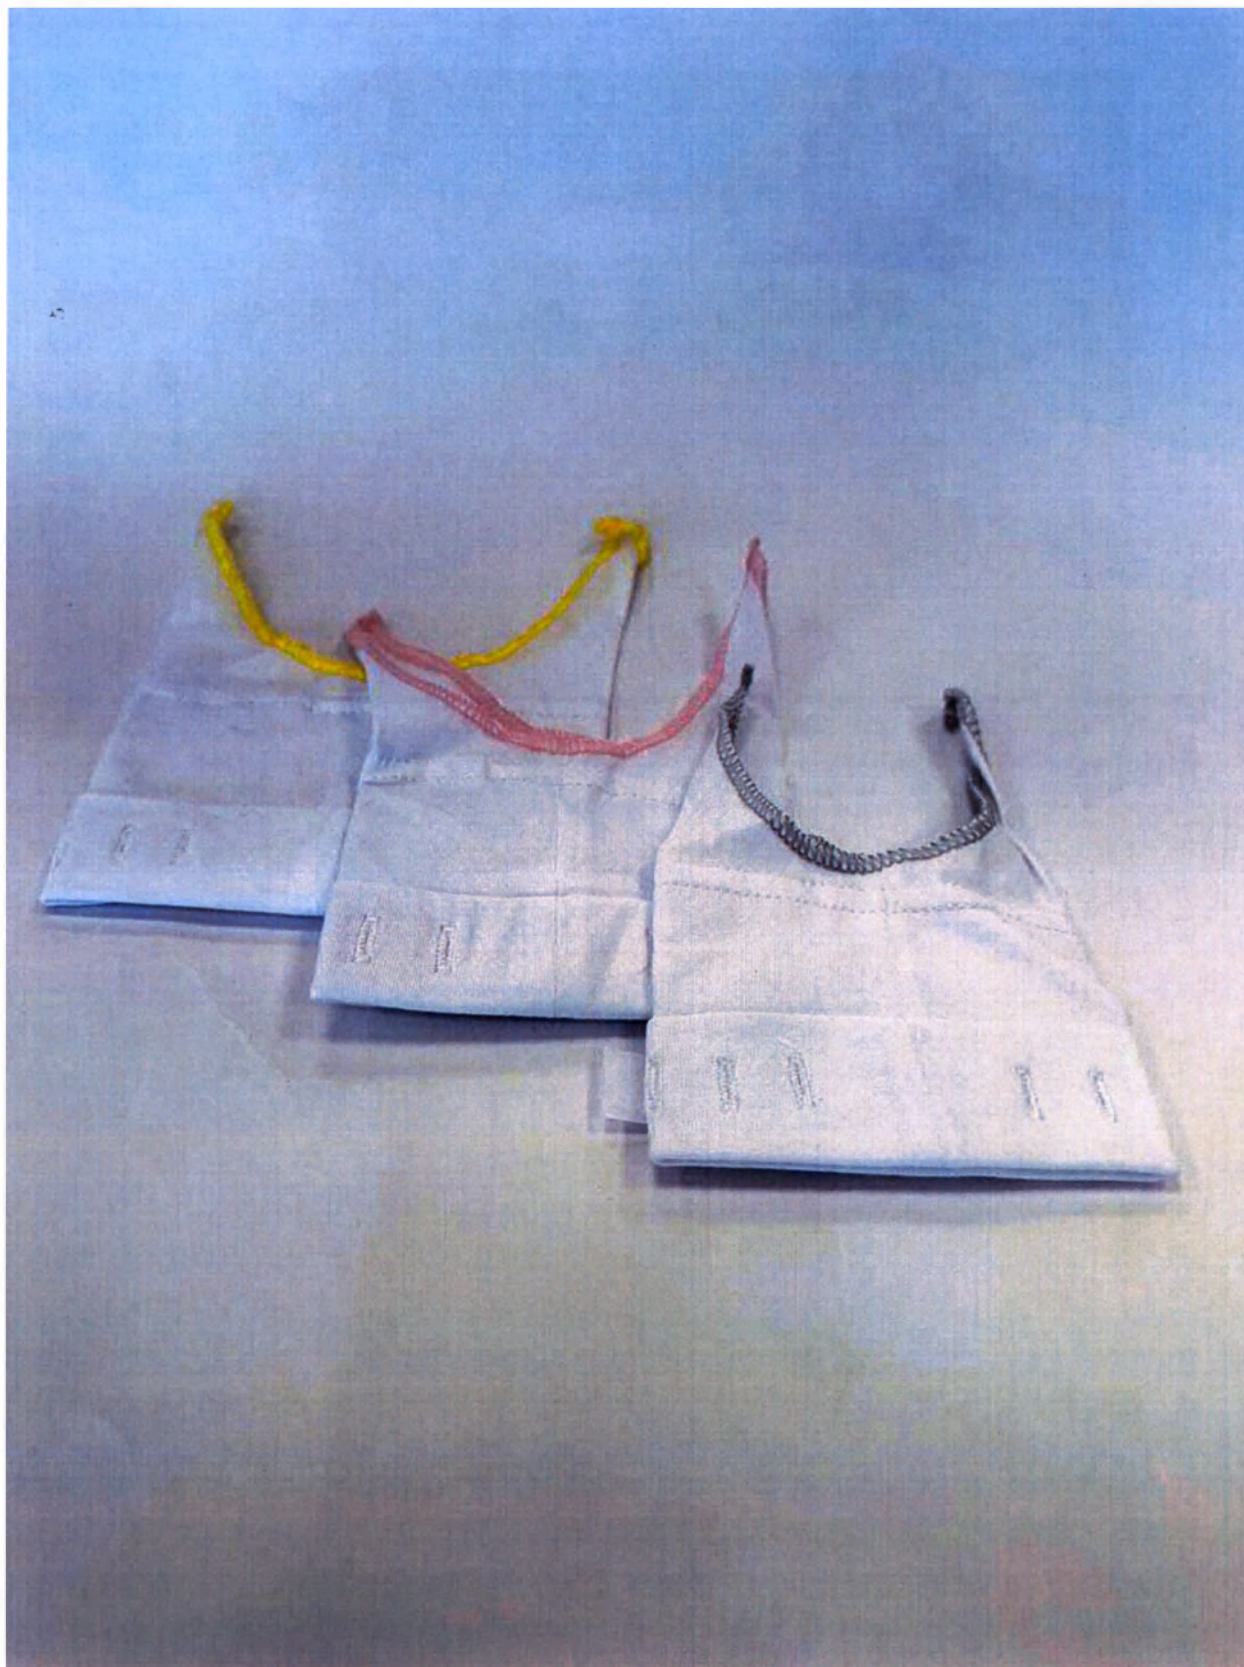


Рисунок 21 – Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции лёгких для лечения новорожденных. Шапочки-фиксаторы дыхательные, размер 00, ИНВGY00/10. Шапочки-фиксаторы дыхательные, размер 0, ИНВРК0/10. Шапочки-фиксаторы дыхательные, размер 2, ИНВYE2/10 (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10229 от 28.01.2020)



Рисунок 22 – Упаковка БИНВЛ в соответствии с чертежом 6Т4.160.203 СБ



Рисунок 23 – Упаковка стойки в соответствии с чертежом 6Т4.160.208 СБ

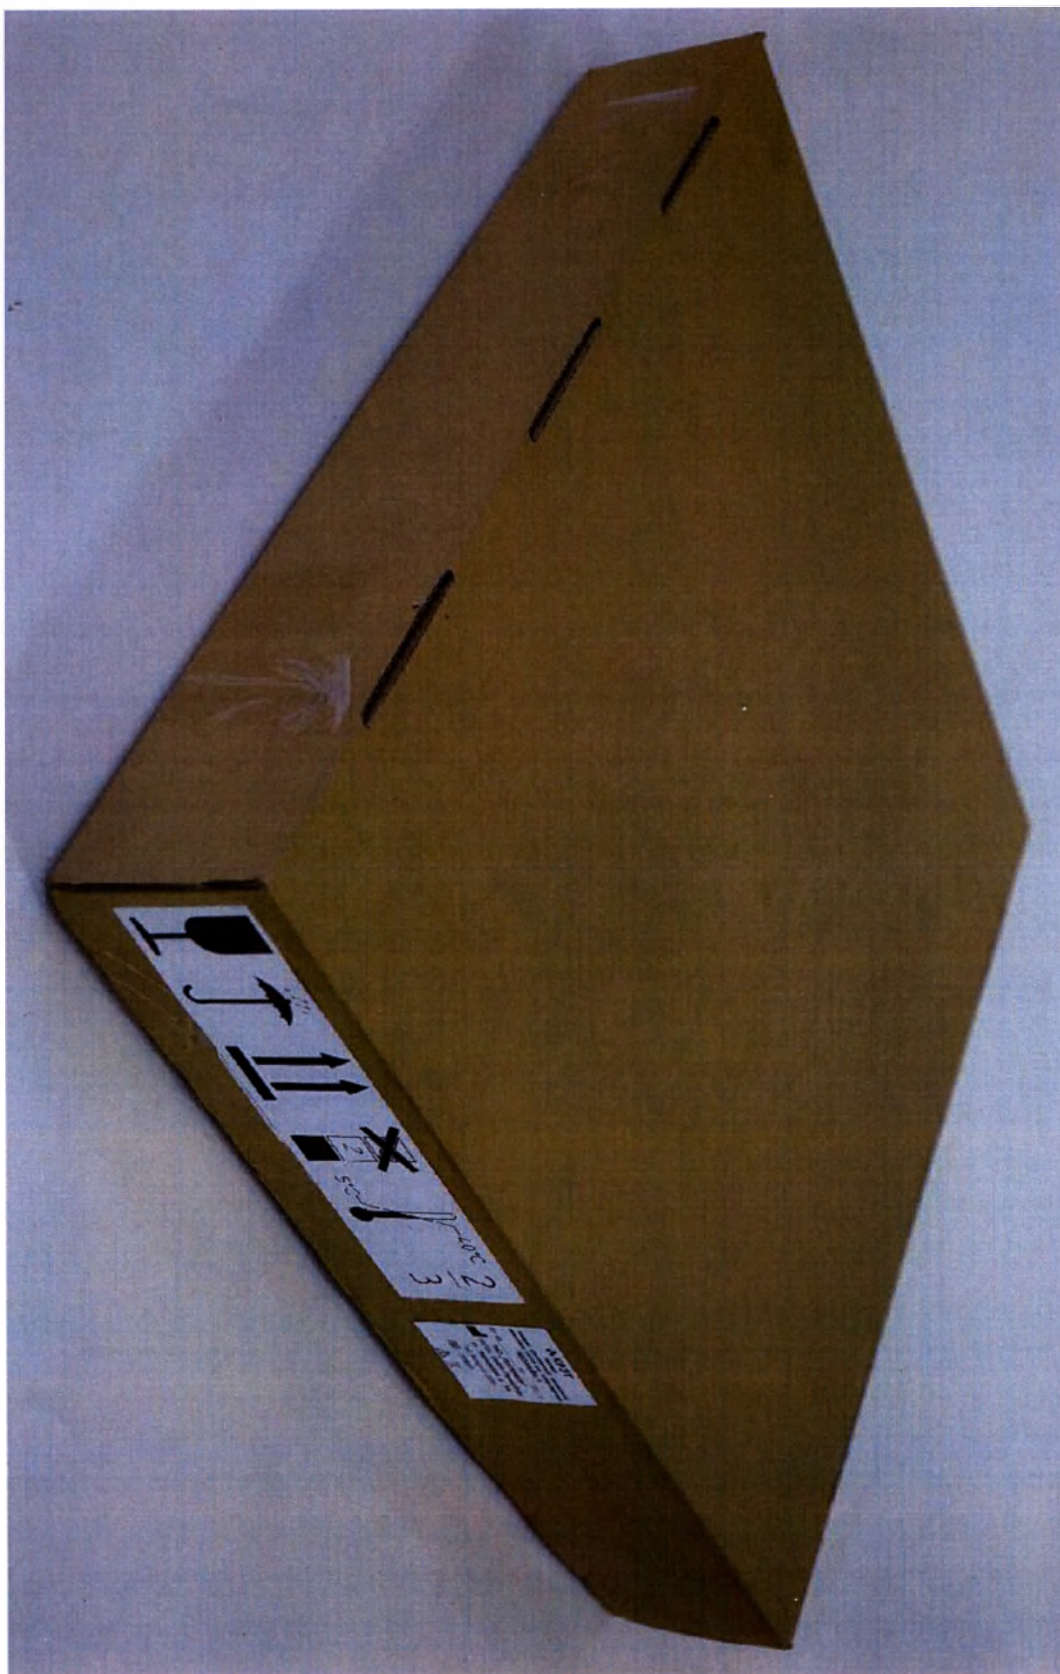


Рисунок 24 – Упаковка колесной базы в соответствии с чертежом 6Т4.160.207 СБ



Рисунок 25 – Транспортная упаковка «Аппарата искусственной неинвазивной вентиляции легких для новорожденных НЕОЛАЙН-1»

В настоящем документе прошито
и пронумеровано 26 лист 06
Двадцать шесть




Генеральный директор
ПАО «Техприбор»

И. В. Абрамян

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор


ПАО «Техприбор»


_____ А.Ю. Новиков


« 05 » 12 2023 г.

Макеты маркировки


**«Аппарат искусственной неинвазивной вентиляции легких для
новорожденных НЕОЛАЙН-1»**

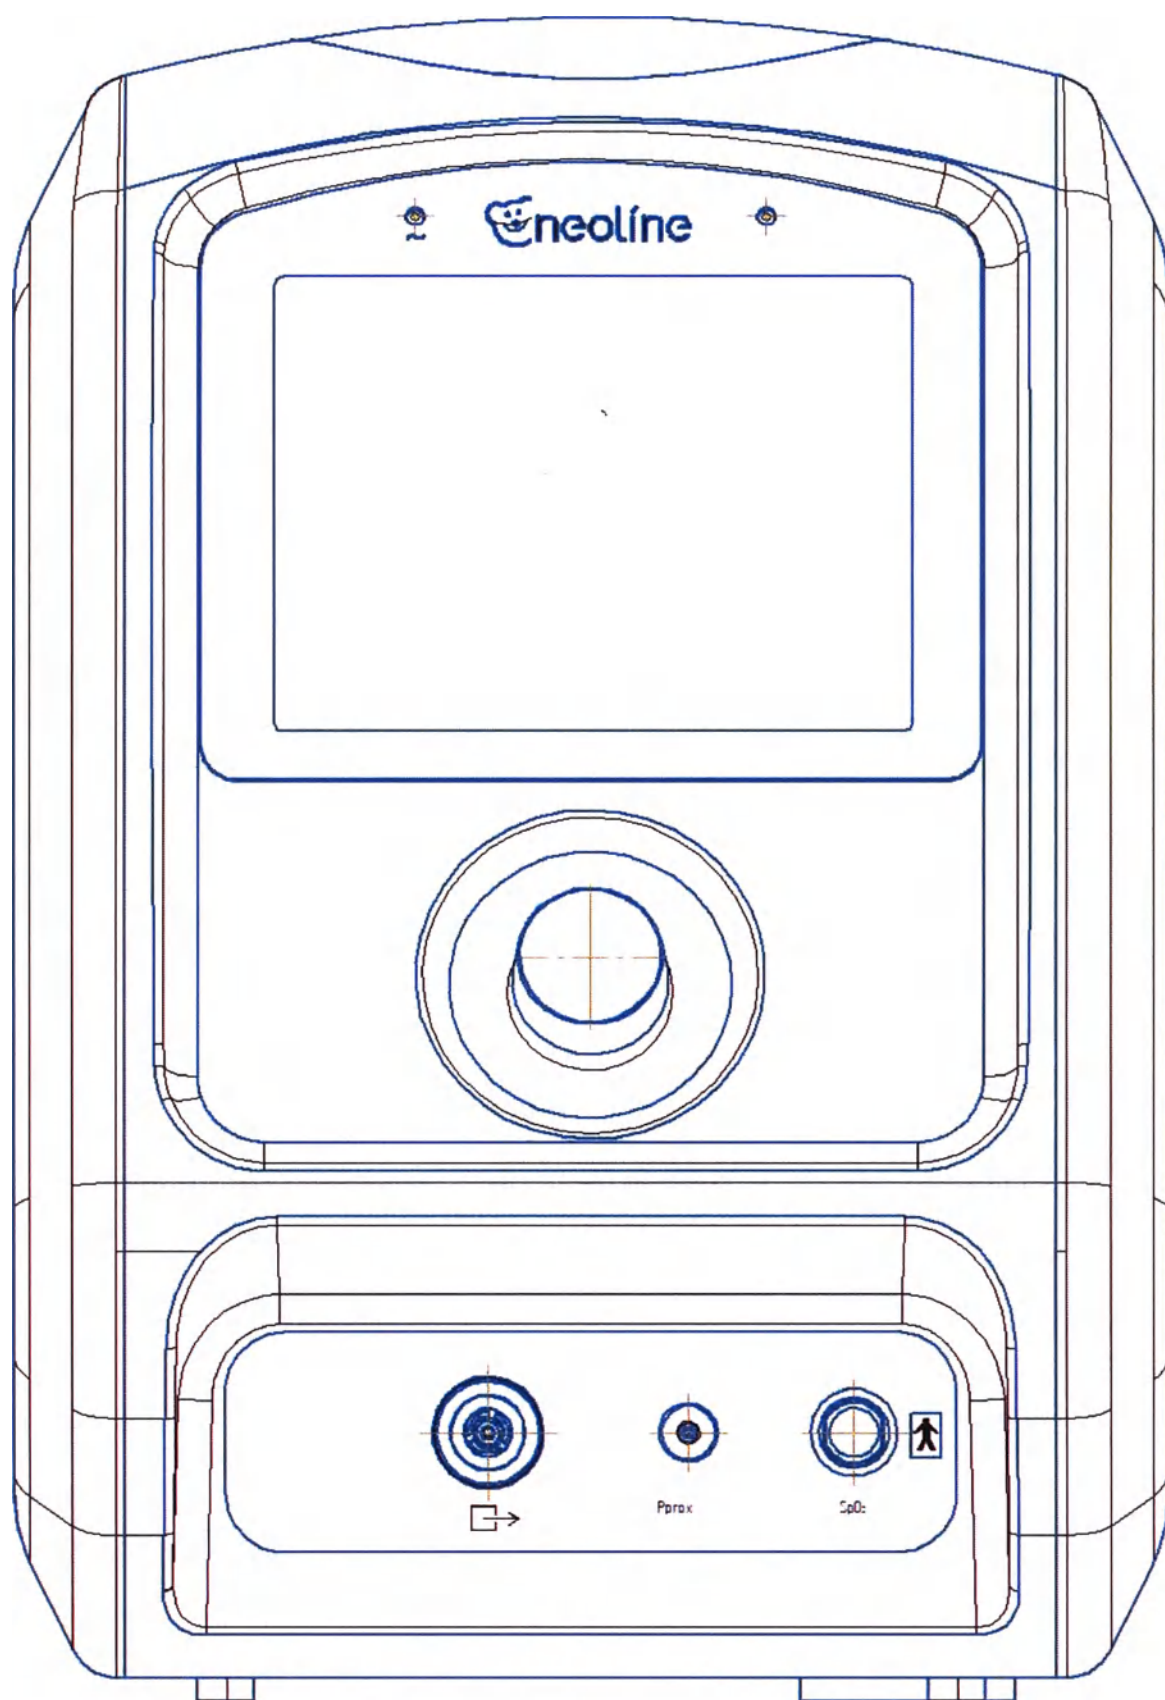

Макет маркировки 1 – Маркировка аппарата искусственной неинвазивной вентиляции легких НЕОЛАЙН-1 (Вид спереди)

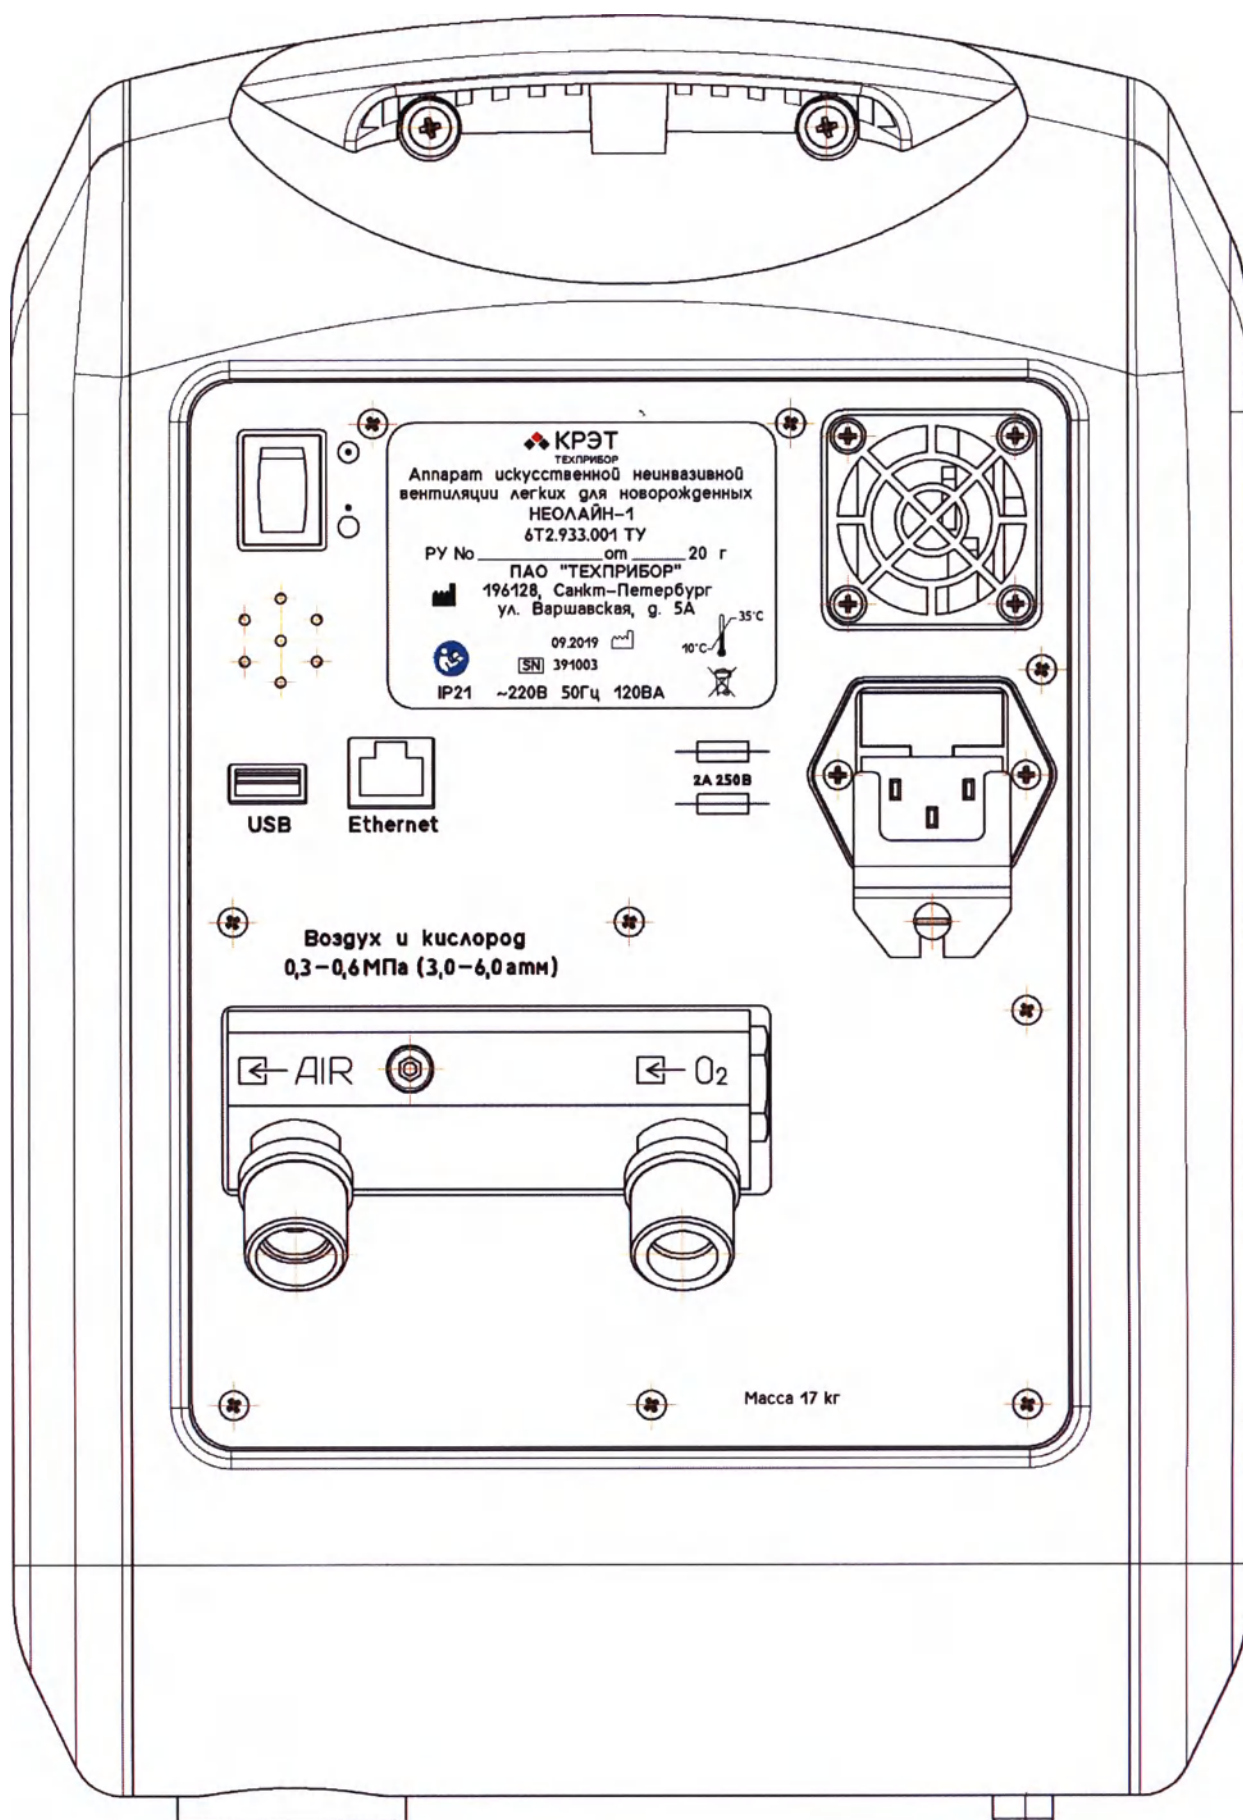

Макет маркировки 2 – Маркировка аппарата искусственной неинвазивной вентиляции легких НЕОЛАЙН-1 (Вид сзади)



1
3

Условия хранения: при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности 35%-80%.


Условия транспортирования: при температуре от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности 75%-100%

БРУТТО

НЕТТО



Макет маркировки 3 – Макет потребительской упаковки БИНВЛ
(6Т4.160.203) (Вид спереди)

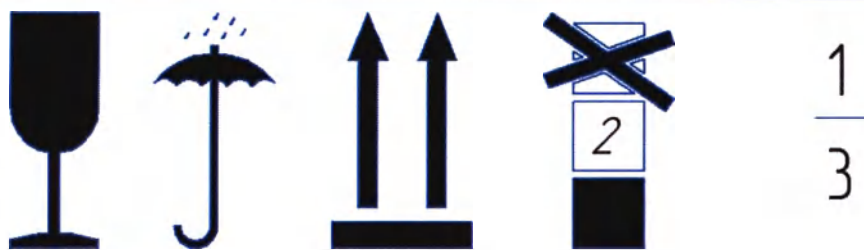

Условия хранения: при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности 35%-80%.

Условия транспортирования: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности 75%-100%

Макет маркировки 4 – Макет потребительской упаковки БИНВЛ (6Т4.160.203) (Вид сбоку)








Условия хранения: при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности 35%-80%.

Условия транспортирования: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности 75%-100%



2

3

Макет маркировки 5 - Макет потребительской упаковки основания стойки (6Т4.160.207) (Вид спереди)






Условия хранения: при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности 35%-80%.

Условия транспортирования: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности 75%-100%


БРУТТО

НЕТТО


2

3

Макет маркировки 6 - Макет потребительской упаковки основания стойки (6Т4.160.207) (Вид сбоку)

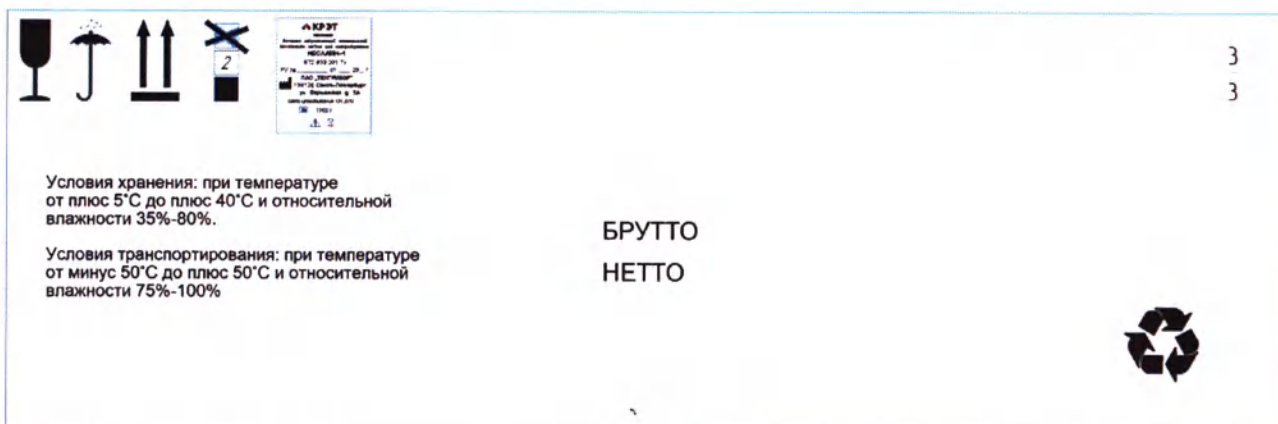

Макет маркировки 7 - Макет потребительской упаковки стойки (6Т4.160.208)
(Вид спереди)

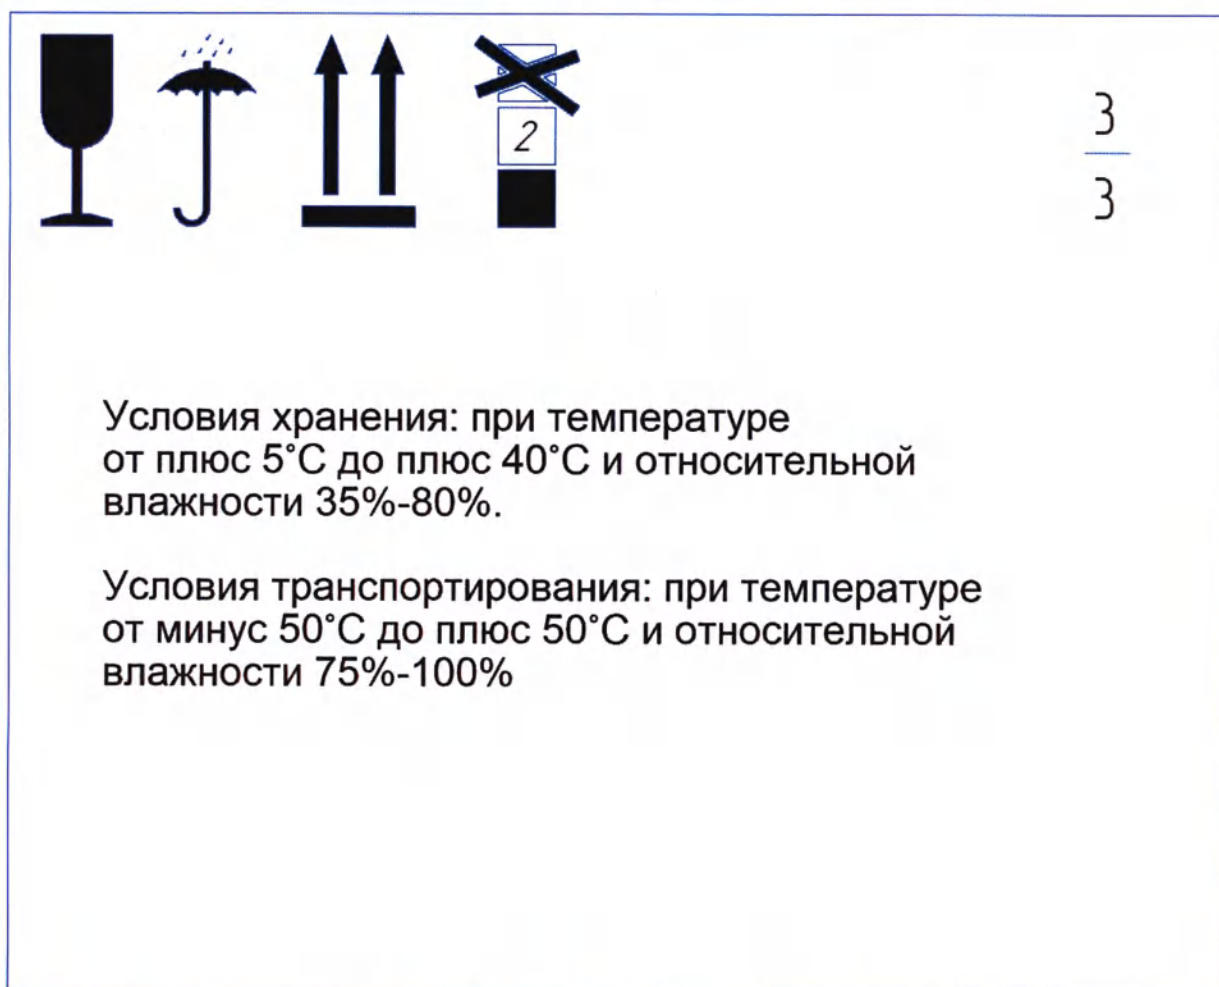

Макет маркировки 8 - Макет потребительской упаковки стойки (6Т4.160.208)
(Вид сбоку)



Условия хранения:
при температуре
от плюс 5°C до плюс 40°C
и относительной
влажности 35%-60%.

Условия транспортирования:
при температуре
от минус 30°C до плюс 50°C
и относительной
влажности 75%-100%.

БРУТТО
НЕТТО

Аппарат искусственной
неинвазивной вентиляции
легких для новорожденных

НЕОЛАЙН-1


6T2.933.001 TV

АКРОТ
ООО, ИНН 5017010000
100120, Челябинская
об., Екатеринбург, д. 38


Рисунок

Рисунок

Макет маркировки 9 - Макет транспортной упаковки (6T4.171.055) (Вид спереди)

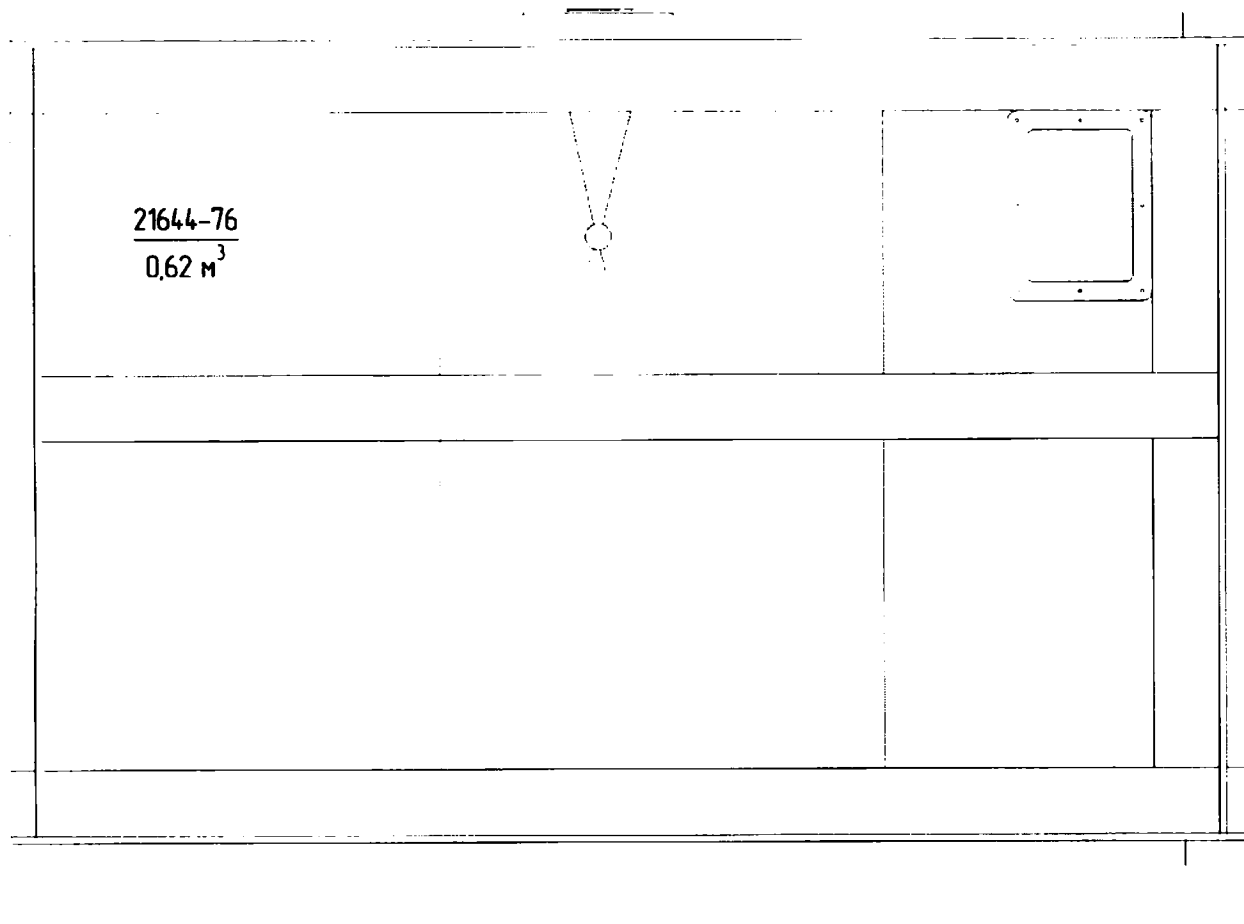

Макет маркировки 10 - Макет транспортной упаковки (6T4.171.055) (Левый бок)

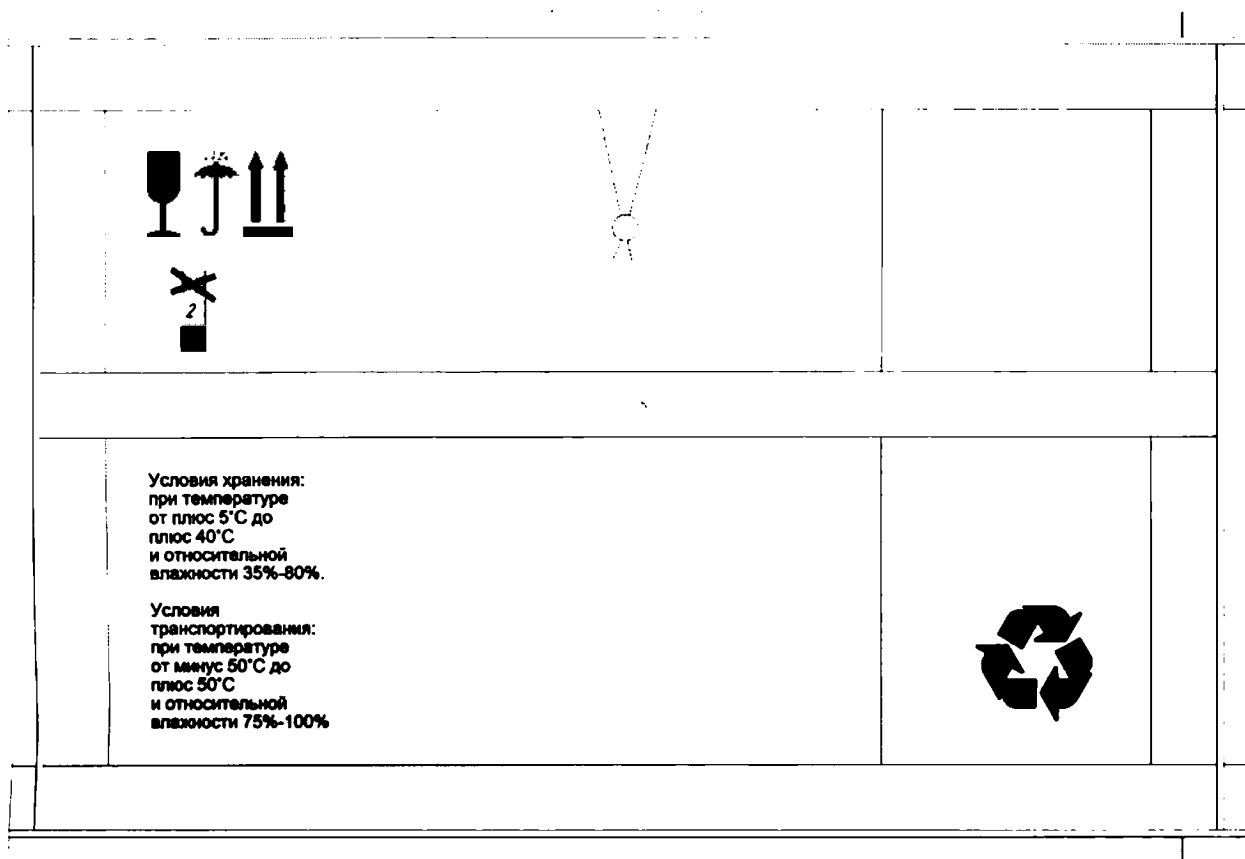

Макет маркировки 10 - Макет транспортной упаковки (6Т4.171.055) (Правый бок)

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ №1

В настоящем ящике № 1 по накладной № _____

от " 31 " 07 2023г. упаковано 19 штук коробок

со следующими изделиями

№ п/п	Наименование, тип и номера изделий	Количество коробок
1	Неопайн-1 1/3 6Т4.160.203 №391003 БИНВЛ (6Т3.280.001)	1шт.
2	Неопайн-1 2/3 6Т4.160.207 №391003 Основание стойки с колесами	1шт.
3	Неопайн-1 3/3 6Т4.160.208 №391003 Стойка	1шт.
4	MR850 В ориг. Уп. 130731187650 Увлажнитель дыхательных смесей	1шт.
5	900MR860 В ориг. Уп. 150724 Температурный датчик для увлажнителя	1шт.
6	900MR806 В ориг. Уп. 2102272023 Кабель гибкого нагревателя	1шт.
7	MR290 В ориг. Уп. 901761 А Камера увлажнителя (упаковка - 10 шт)	1шт.
8	ИНС4064/Н В ориг. Уп. 2020-10025 Дыхательный контур пациента с генератором дыхания (Упаковка - 20 шт)	1шт.
9	VX8021 В ориг. Уп. 2022-03221 Канюли назальные, размер S, (упаковка - 10 шт)	1шт.
10	VX8022 В ориг. Уп. 2019-06066 Канюли назальные, размер M, (упаковка - 10 шт)	1шт.
11	VX8023 В ориг. Уп. 2022-06492 Канюли назальные, размер L, (упаковка - 10 шт)	1шт.
12	VX8030 В ориг. Уп. 2021-03185 Маски лицевые дыхательные, размер S, (упаковка - 10 шт)	1шт.
13	VX8031 В ориг. Уп. 2022-06494 Маски лицевые дыхательные, размер M, (упаковка - 10 шт)	1шт.
14	VX8032 В ориг. Уп. 2021-03296 Маски лицевые дыхательные, размер L, (упаковка - 10 шт)	1шт.
15	VX8033 В ориг. Уп. 2019-09070 Маски лицевые дыхательные, размер XL, (упаковка - 10 шт)	1шт.
16	ИНВGY00/10 В ориг. Уп. 2021-04217 Шапочки-фиксаторы дыхательные, Размер 00, (упаковка - 10 шт)	1шт.
17	ИНВРK0/10 В ориг. Уп. 2020-10011 Шапочки-фиксаторы дыхательные, Размер 0, (упаковка - 10 шт)	1шт.
18	ИНВYE2/10 В ориг. Уп. 2021-02079 Шапочки-фиксаторы дыхательные, Размер 2, (упаковка - 10 шт)	1шт.
19	10-50902 В ориг. Уп. 2015550902 Контур пациента, (упаковка - 10 шт)	1шт.

Упаковку произвел: _____

Упаковку проверил: _____

Контролер ОТК _____

Вниманию грузополучателя!

В случае обнаружения дефектов упаковки или недостачи изделий надлежит составить акт, который приложить вместе с упаковочным листом и направить в адрес отправителя

В настоящем документе прошито
и пронумеровано 10 лист 05
Десять

Генеральный директор
ПАО «Техприбор»

К.В. Абрамян

