

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «Компания Алкор Био»  
Полынцева Д.Г.  
«12» 05 2024 г.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для качественного иммуноферментного  
определения поверхностного антигена вируса гепатита В  
«ГепатитИФА-HBsAg-скрин», по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023»,  
производства ООО «Компания Алкор Био»**

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения  
поверхностного антигена вируса гепатита В «ГепатитИФА-НВsAg-скрин»,  
по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения №1, кат № 200-89

На коробку:

ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО**

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162  
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779  
горячая линия: +7 (800) 234 3779

ООО «Компания Алкор Био»  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., 40, лит. А

**ГепатитИФА-НВsAg-скрин**  
Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения  
поверхностного антигена  
вируса гепатита В «ГепатитИФА-НВsAg-скрин», по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023

LOT E002

REF 200-89

IVD

2023-05-15

2024-08-15

96

8°C

2°C

!

☂

**Комплект поставки:**

|                                                |                |                                        |                  |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------|
| 1. Стрипы с моноклональными антителами к НВsAg | 1 упак.        | 8. Раствор ТМБ                         | 1 фл. (14 мл)    |
| 2. Отрицательная контрольная проба             | 1 фл. (2,5 мл) | 9. Стоп-реагент                        | 2 фл. (по 50 мл) |
| 3. Слабоположительная контрольная проба        | 1 фл. (3 мл)   | 10. Пленка для ИФА планшетов           | 2 шт             |
| 4. Положительная контрольная проба             | 1 фл. (3 мл)   | 11. Одноразовые ванночки               | 2 шт             |
| 5. Буфер А                                     | 1 фл. (6 мл)   | 12. Одноразовые наконечники            | 16 шт            |
| 6. Конъюгат Е                                  | 1 фл. (8 мл)   | 13. Пакет закрывающийся полистиленовый | 1 шт             |
| 7. Буфер Н (20X)                               | 1 фл. (50 мл)  | 14. Инструкция                         | 1 шт             |
|                                                |                | 15. Паспорт                            | 1 шт             |

ТУ 21.20.23-697-98539446-2023  
РУ №

2'000027'731428

ГепатитИФА-НВsAg-скрин

2024-08-15

E002

2'000027'731428

Для профессионального применения

www.alkorbio.ru

## Вариант исполнения №1, кат № 200-89

На пакет/флакон:

АЛКОР БИО  
**Стрипы с моноклональными  
антителами к НВsAg  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин**  
серия № **E002**  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готовы к использованию  
только для диагностики in vitro

-1 шт.

АЛКОР БИО  
**Отрицательная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин**  
объем 2,5 мл годен до 2024-08-15  
серия № E002 хранить при +2...+8 °C  
готова к использованию  
только для диагностики in vitro

-1 шт.

АЛКОР БИО  
**Слабоположительная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин**  
объем 3 мл годен до 2024-08-15  
серия № E002 хранить при +2...+8 °C  
готова к использованию  
только для диагностики in vitro

-1 шт.

АЛКОР БИО  
**Положительная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин**  
объем 3 мл годен до 2024-08-15  
серия № E002 хранить при +2...+8 °C  
готова к использованию  
только для диагностики in vitro

-1 шт.

АЛКОР БИО  
**Буфер А  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин**  
объем 6 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

-1 шт.

АЛКОР БИО  
**Конъюгат Е  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин**  
объем 8 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

-1 шт.

АЛКОР БИО  
**Буфер Н (20X)**  
объем 50 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
950 мл дист. воды  
только для диагностики in vitro

-1 шт.

АЛКОР БИО  
**Раствор ТМБ**  
объем 14 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

-1 шт.

АЛКОР БИО  
**Стоп-реагент**  
объем 50 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

-2 шт.

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения  
поверхностного антигена вируса гепатита В «ГепатитИФА-НВsAg-скрин»,  
по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО**

Вариант исполнения №2, кат № 200-90

На коробку:

ГепатитИФА-НВsAg-скрин

LOT E002

2024-08-15

ТУ 21.20.23-697-98539446-2023

RU №

Для профессионального применения

V002 F1

АЛКОР БИО

www.alkorbio.ru

2000027 742318

ООО «Компания Алкор Био»  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., 40, лит. А

ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО**

**ГепатитИФА-НВsAg-скрин**

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения поверхностного антигена  
вируса гепатита В «ГепатитИФА-НВsAg-скрин», по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023

**Комплект поставки:**

|                                                |                   |                                        |                  |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1. Стрипы с моноклональными антителами к НВsAg | 2 упак.           | 8. Раствор ТМБ                         | 2 фл. (по 14 мл) |
| 2. Отрицательная контрольная проба             | 2 фл. (по 2,5 мл) | 9. Стоп-реагент                        | 3 фл. (по 50 мл) |
| 3. Слабоположительная контрольная проба        | 1 фл. (3 мл)      | 10. Пленка для ИФА планшетов           | 4 шт.            |
| 4. Положительная контрольная проба             | 1 фл. (3 мл)      | 11. Одноразовые ванночки               | 2 шт.            |
| 5. Буфер А                                     | 2 фл. (по 6 мл)   | 12. Одноразовые наконечники            | 16 шт.           |
| 6. Конъюгат Е                                  | 2 фл. (по 8 мл)   | 13. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 2 шт.            |
| 7. Буфер Н (20Х)                               | 2 фл. (по 50 мл)  | 14. Инструкция                         | 1 шт.            |
|                                                |                   | 15. Паспорт                            | 1 шт.            |

LOT E002

REF 200-90

2023-05-15

2024-08-15

IVD

2°C-8°C

192

Биобезопасность

ГепатитИФА-НВsAg-скрин

LOT E002

2024-08-15

ТУ 21.20.23-697-98539446-2023

RU №

Для профессионального применения

V002 F1

ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО**

www.alkorbio.ru

2000027 742318

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения  
поверхностного антигена вируса гепатита В «ГепатитИФА-НВsAg-скрин»,  
по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023»

Макет этикеток



## Вариант исполнения №2, кат № 200-90

На пакет/флакон:

АЛКОР БИО  
Стрипы с моноклональными  
антителами к НВsAg  
**ГепатитИФА-НВsAg-скрин**  
серия № **E002**  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готовы к использованию  
только для диагностики in vitro

-2шт.

АЛКОР БИО  
Отрицательная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин  
объем 2,5 мл годен до 2024-08-15  
серия № E002 хранить при +2...+8°C  
готова к использованию  
только для диагностики in vitro

-2шт.

АЛКОР БИО  
Слабоположительная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин  
объем 3 мл годен до 2024-08-15  
серия № E002 хранить при +2...+8°C  
готова к использованию  
только для диагностики in vitro

-1шт.

АЛКОР БИО  
Положительная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин  
объем 3 мл годен до 2024-08-15  
серия № E002 хранить при +2...+8°C  
готова к использованию  
только для диагностики in vitro

-1шт.

АЛКОР БИО  
Буфер А  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин  
объем 6 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8°C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

-2шт.

АЛКОР БИО  
Конъюгат Е  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин  
объем 8 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8°C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

-2шт.

АЛКОР БИО  
Буфер Н (20X)  
объем 50 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8°C  
950 мл дист. воды  
только для диагностики in vitro

-2шт.

АЛКОР БИО  
Раствор ТМБ  
объем 14 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8°C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

-2шт.

АЛКОР БИО  
Стоп-реагент  
объем 50 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

-3шт.

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения  
поверхностного антигена вируса гепатита В «ГепатитИФА-НВsAg-скрин»,  
по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО**

Вариант исполнения №3, кат № 200-87

На коробку:



ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО**

www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., 40, лит. А

ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО**

**ГепатитИФА-НВsAg-скрин**

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения поверхностного антигена  
вируса гепатита В «ГепатитИФА-НВsAg-скрин», по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162  
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779  
горячая линия: +7 (800) 234 3779

**Комплект поставки:**

|                                                |                   |                                        |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1. Стрипы с моноклональными антителами к НВsAg | 5 упак.           | 8. Раствор ТМБ                         | 5 фл. (по 14 мл)  |
| 2. Отрицательная контрольная проба             | 4 фл. (по 2,5 мл) | 9. Стоп-реагент                        | 3 фл. (по 100 мл) |
| 3. Слабоположительная контрольная проба        | 3 фл. (по 3 мл)   | 10. Пленка для ИФА планшетов           | 10 шт.            |
| 4. Положительная контрольная проба             | 3 фл. (по 3 мл)   | 11. Одноразовые ванночки               | 4 шт.             |
| 5. Буфер А                                     | 1 фл. (30 мл)     | 12. Одноразовые наконечники            | 32 шт.            |
| 6. Конъюгат Е                                  | 5 фл. (по 8 мл)   | 13. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 5 шт.             |
| 7. Буфер Н (20Х)                               | 3 фл. (по 100 мл) | 14. Инструкция                         | 1 шт.             |
|                                                |                   | 15. Паспорт                            | 1 шт.             |

**LOT** E002

**REF** 200-87

2023-05-15

2024-08-15

**IVD**



480



### ГепатитИФА-НВsAg-скрин

**LOT** E002  2024-08-15

ТУ 21 20 23-697-98539446-2023

РУ №

Для профессионального применения

V002

F1



ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО**

www.alkorbio.ru

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения  
поверхностного антигена вируса гепатита В «ГепатитИФА-НВsAg-скрин»,  
по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023»

Макет этикеток



### Вариант исполнения №3, кат № 200-87

На пакет/флакон:

Стрипы с моноклональными  
антителами к НВsAg

**ГепатитИФА-НВsAg-скрин**

серия № **E002**

годен до 2024-08-15

хранить при +2...+8 °C

готовы к использованию

только для диагностики in vitro

-5шт.

Отрицательная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин

объем 2,5 мл годен до 2024-08-15

серия № E002 хранить при +2...+8°C

готова к использованию

только для диагностики in vitro

-4шт.

Слабopоложительная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин

объем 3 мл годен до 2024-08-15

серия № E002 хранить при +2...+8°C

готова к использованию

только для диагностики in vitro

-3шт.

Положительная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин

объем 3 мл годен до 2024-08-15

серия № E002 хранить при +2...+8°C

готова к использованию

только для диагностики in vitro

-3шт.

**Буфер А**

ГепатитИФА-НВsAg-скрин

объем 30 мл

серия № E002

годен до 2024-08-15

хранить при +2...+8°C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

-1шт.

**Конъюгат Е**

ГепатитИФА-НВsAg-скрин

объем 8 мл

серия № E002

годен до 2024-08-15

хранить при +2...+8°C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

-5шт.

**Буфер Н (20X)**

объем 100 мл

серия № E002

годен до 2024-08-15

хранить при +2...+8°C

1900 мл дист. воды

только для диагностики in vitro

-3шт.

**Раствор ТМБ**

объем 14 мл

серия № E002

годен до 2024-08-15

хранить при +2...+8°C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

-5шт.

**Стоп-реагент**

объем 100 мл

серия № E002

годен до 2024-08-15

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

-3шт.

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения  
поверхностного антигена вируса гепатита В «ГепатитИФА-НВsAg-скрин»,  
по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023»

Макет этикеток



## Вариант исполнения №4, кат № 200-88

На коробку:



ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО**  
www.alkorbio.ru

ООО «Компания Алкор Био»  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., 40, лит. А

ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО**

**ГепатитИФА-НВsAg-скрин**

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения поверхностного антигена  
вируса гепатита В «ГепатитИФА-НВsAg-скрин», по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023

**Комплект поставки:**

|                                                |                   |                                        |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1. Стрипы с моноклональными антителами к НВsAg | 10 упак.          | 8. Раствор ТМБ                         | 10 фл. (по 14 мл) |
| 2. Отрицательная контрольная проба             | 8 фл. (по 2,5 мл) | 9. Стоп-реагент                        | 6 фл. (по 100 мл) |
| 3. Слабopоложительная контрольная проба        | 5 фл. (по 3 мл)   | 10. Пленка для ИФА планшетов           | 20 шт.            |
| 4. Положительная контрольная проба             | 5 фл. (по 3 мл)   | 11. Одноразовые ванночки               | 4 шт.             |
| 5. Буфер А                                     | 2 фл. (по 30 мл)  | 12. Одноразовые наконечники            | 32 шт.            |
| 6. Конъюгат Е                                  | 10 фл. (по 8 мл)  | 13. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 10 шт.            |
| 7. Буфер Н (20Х)                               | 5 фл. (по 100 мл) | 14. Инструкция                         | 1 шт.             |
|                                                |                   | 15. Паспорт                            | 1 шт.             |


**LOT** E002

**REF** 200-88

2023-05-15

2024-08-15

**IVD**

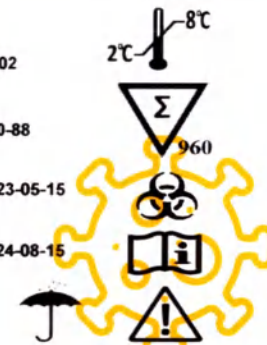

**ГепатитИФА-НВsAg-скрин**

**LOT** E002  2024-08-15

ТУ 21 20 23-697-98539446-2023

РУ №

Для профессионального применения

V002 F1

ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО** www.alkorbio.ru



«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения  
поверхностного антигена вируса гепатита В «ГепатитИФА-НВsAg-скрин»,  
по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023»

Макет этикеток



## Вариант исполнения №4, кат № 200-88

На пакет/флакон:

АЛКОР БИО  
Стрипы с моноклональными  
антителами к НВsAg  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готовы к использованию  
только для диагностики in vitro

V001

-10 шт.

АЛКОР БИО  
Отрицательная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин  
объем 2,5 мл годен до 2024-08-15  
серия № E002 хранить при +2...+8 °C  
готова к использованию  
только для диагностики in vitro

V001

-8 шт.

АЛКОР БИО  
Слабоположительная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин  
объем 3 мл годен до 2024-08-15  
серия № E002 хранить при +2...+8 °C  
готова к использованию  
только для диагностики in vitro

V001

-5 шт.

АЛКОР БИО  
Положительная контрольная проба  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин  
объем 3 мл годен до 2024-08-15  
серия № E002 хранить при +2...+8 °C  
готова к использованию  
только для диагностики in vitro

V001

-5 шт.

АЛКОР БИО  
Буфер А  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин  
объем 30 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

V001

-2 шт.

АЛКОР БИО  
Конъюгат Е  
ГепатитИФА-НВsAg-скрин  
объем 8 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

V001

-10 шт.

АЛКОР БИО  
Буфер Н (20X)  
объем 100 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
1900 мл дист. воды  
только для диагностики in vitro

V001

-5 шт.

АЛКОР БИО  
Раствор ТМБ  
объем 14 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

V001

-10 шт.

АЛКОР БИО  
Стоп-реагент  
объем 100 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готов к использованию  
только для диагностики in vitro

V001

-6 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

9 ( двадцать ) лист 10

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «Компания Алкор Био»  
Полынцева Д.Г.  
2024 г.



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для качественного иммуноферментного  
определения поверхностного антигена вируса гепатита В  
«ГепатитИФА-HBsAg-скрин», по ТУ 21.20.23-697-98539446-2023»,  
производства ООО «Компания Алкор Био»**

000 «Kourama Argo Inc»  
p6799, *Matrisoponad* sp. n. 40, str. A  
enp6799 (812) 677-8779

[illegible][illegible]

Three bottles of Eppendorf H 2000 Cryo-Storage Vials, 96 x 16 mm, with a white cap and a blue label. The label includes the Eppendorf logo, product name, dimensions, and a warning symbol.

[illegible]

**СТРИПЫ С МОНОКЛОНИАЛЬНЫМИ АНТИТЕЛАМИ К НВbAg**  
**ГепатитифА-НВbAg-скрин**  
серия № E002  
пробирки по 2 шт. в упаковке  
пробирки в индивидуальной упаковке для диагностики в лабораториях

**СТРИПЫ С МОНОКЛОНИАЛЬНЫМИ АНТИТЕЛАМИ К НВbAg**  
**ГепатитифА-НВbAg-скрин**  
серия № E002  
пробирки по 2 шт. в упаковке  
пробирки в индивидуальной упаковке для диагностики в лабораториях

**ГРУППА КОМПАНИЙ АЛКОР БИО**  
**ГепатитифА-НВbAg-скрин**

Набор реагентов для экспресс-диагностики антител к НВbAg в сыворотке крови человека в 15 минут

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

|                                                    |       |           |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg  | 2 шт. | по 10 шт. |
| 2. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg  | 2 шт. | по 10 шт. |
| 3. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg  | 2 шт. | по 10 шт. |
| 4. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg  | 2 шт. | по 10 шт. |
| 5. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg  | 2 шт. | по 10 шт. |
| 6. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg  | 2 шт. | по 10 шт. |
| 7. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg  | 2 шт. | по 10 шт. |
| 8. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg  | 2 шт. | по 10 шт. |
| 9. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg  | 2 шт. | по 10 шт. |
| 10. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg | 2 шт. | по 10 шт. |
| 11. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg | 2 шт. | по 10 шт. |
| 12. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg | 2 шт. | по 10 шт. |
| 13. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg | 2 шт. | по 10 шт. |
| 14. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg | 2 шт. | по 10 шт. |
| 15. Сыворотка с моноклональными антителами к НВbAg | 2 шт. | по 10 шт. |

ООО «Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожная ул., д. 40, лит. А  
Телефон: (812) 677-9179

ПАСПОРТ № 002

«Набор реагентов для экспресс-диагностики антител к НВbAg в сыворотке крови человека в 15 минут»  
серия № E002

Количество: 20 шт.  
Код: 002

Срок годности: 12 месяцев  
Условия хранения: при температуре от +2 до +8 °С

Информация о наборе реагентов для экспресс-диагностики антител к НВbAg в сыворотке крови человека в 15 минут

Серия № E002

Количество: 20 шт.

Код: 002

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения: при температуре от +2 до +8 °С

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО  
ГЕНЕТИЧЕСКОГО СКОРИН

Инструкция по применению

1. Назначение

2. Состав

3. Фармакодинамика

4. Фармакокинетика

5. Показания к применению

6. Противопоказания

7. Побочные эффекты

8. Лекарственные взаимодействия

9. Беременность и лактация

10. Применение у детей

11. Применение у пожилых

12. Применение при заболеваниях печени и почек

13. Применение при заболеваниях сердца и сосудов

14. Применение при заболеваниях нервной системы

15. Применение при заболеваниях органов дыхания

16. Применение при заболеваниях органов пищеварения

17. Применение при заболеваниях мочеполовой системы

18. Применение при заболеваниях кожи

19. Применение при заболеваниях глаз

20. Применение при заболеваниях слуха и зрения

21. Применение при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

22. Применение при заболеваниях эндокринной системы

23. Применение при заболеваниях иммунной системы

24. Применение при заболеваниях крови

25. Применение при заболеваниях нервной системы

26. Применение при заболеваниях органов чувств

27. Применение при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

28. Применение при заболеваниях эндокринной системы

29. Применение при заболеваниях иммунной системы

30. Применение при заболеваниях крови

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО  
ГЕНЕТИЧЕСКОГО СКОРИН

Инструкция по применению

1. Назначение

2. Состав

3. Фармакодинамика

4. Фармакокинетика

5. Показания к применению

6. Противопоказания

7. Побочные эффекты

8. Лекарственные взаимодействия

9. Беременность и лактация

10. Применение у детей

11. Применение у пожилых

12. Применение при заболеваниях печени и почек

13. Применение при заболеваниях сердца и сосудов

14. Применение при заболеваниях нервной системы

15. Применение при заболеваниях органов дыхания

16. Применение при заболеваниях органов пищеварения

17. Применение при заболеваниях мочеполовой системы

18. Применение при заболеваниях кожи

19. Применение при заболеваниях глаз

20. Применение при заболеваниях слуха и зрения

21. Применение при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

22. Применение при заболеваниях эндокринной системы

23. Применение при заболеваниях иммунной системы

24. Применение при заболеваниях крови

25. Применение при заболеваниях нервной системы

26. Применение при заболеваниях органов чувств

27. Применение при заболеваниях опорно-двигательного аппарата


28. Применение при заболеваниях эндокринной системы

29. Применение при заболеваниях иммунной системы

30. Применение при заболеваниях крови







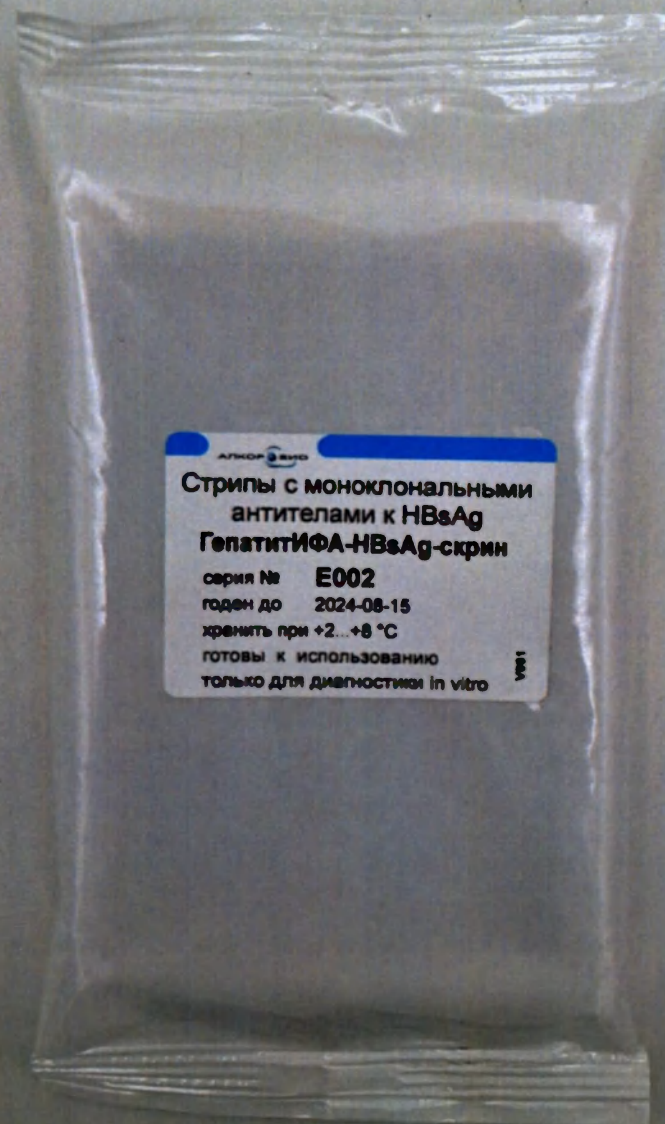

АЛТОР  
Стрипы с моноклональными  
антителами к HBsAg  
ГепатитиФА-HBsAg-скрин  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8 °C  
готовы к использованию  
только для диагностики in vitro

№01

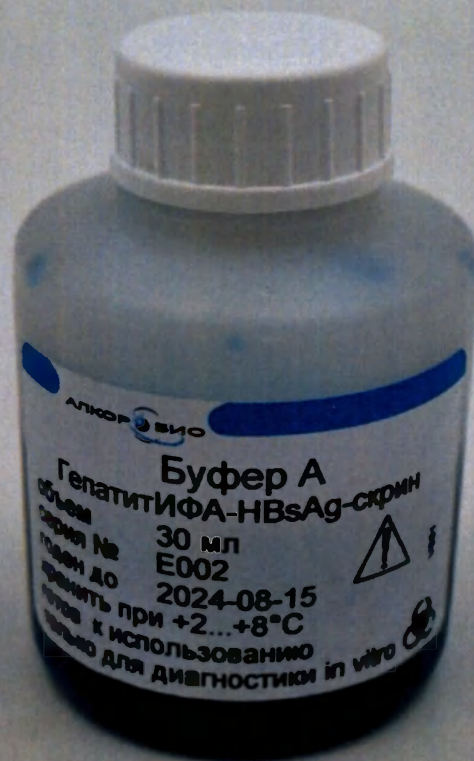


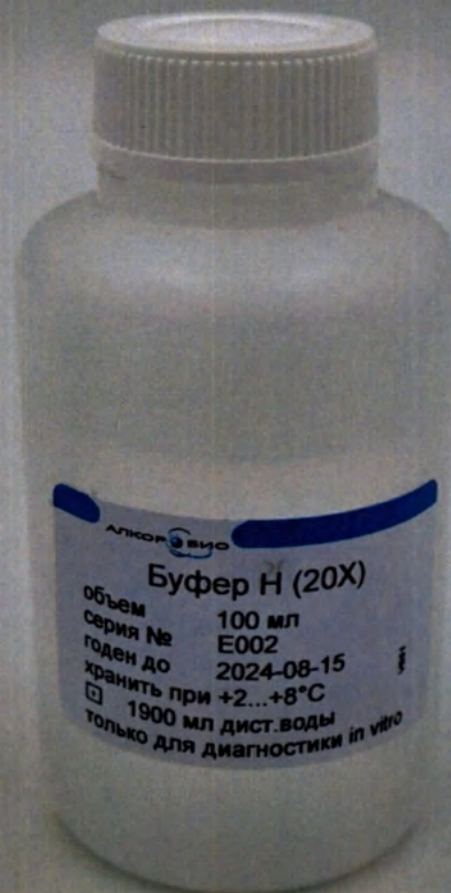


АЛКОР БИО

**Буфер Н (20X)**

объем 100 мл  
серия № E002  
годен до 2024-08-15  
хранить при +2...+8°C  
☐ 1900 мл дист. воды  
только для диагностики in vitro

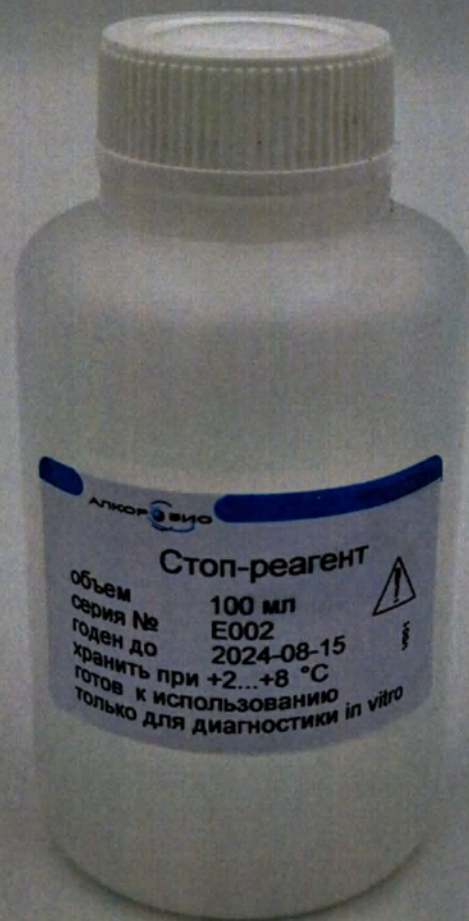

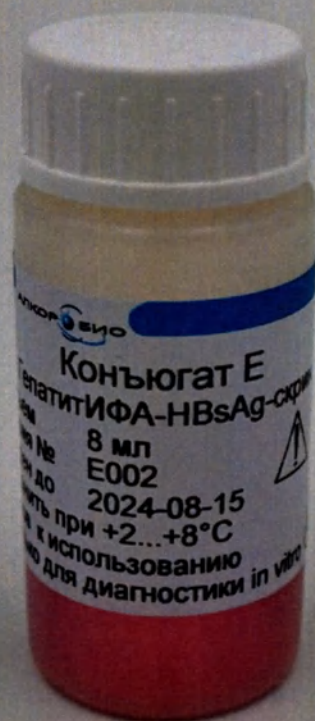







Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

13 (Тринадцать) лист 8

Генеральный директор  
ООО «Компания Алкор-Био»

Д.Б. Полинцев

