

ОКПД2 32.50.13.190

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РиГ Групп Ко»



Д.С. Аллахвердиев/

«2» ноября 2023

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**


Производства: Общество с ограниченной ответственностью «РиГ Групп Ко»
199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Санкт-Петербург,
2023


Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 5,0 мм




Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 5,0 мм

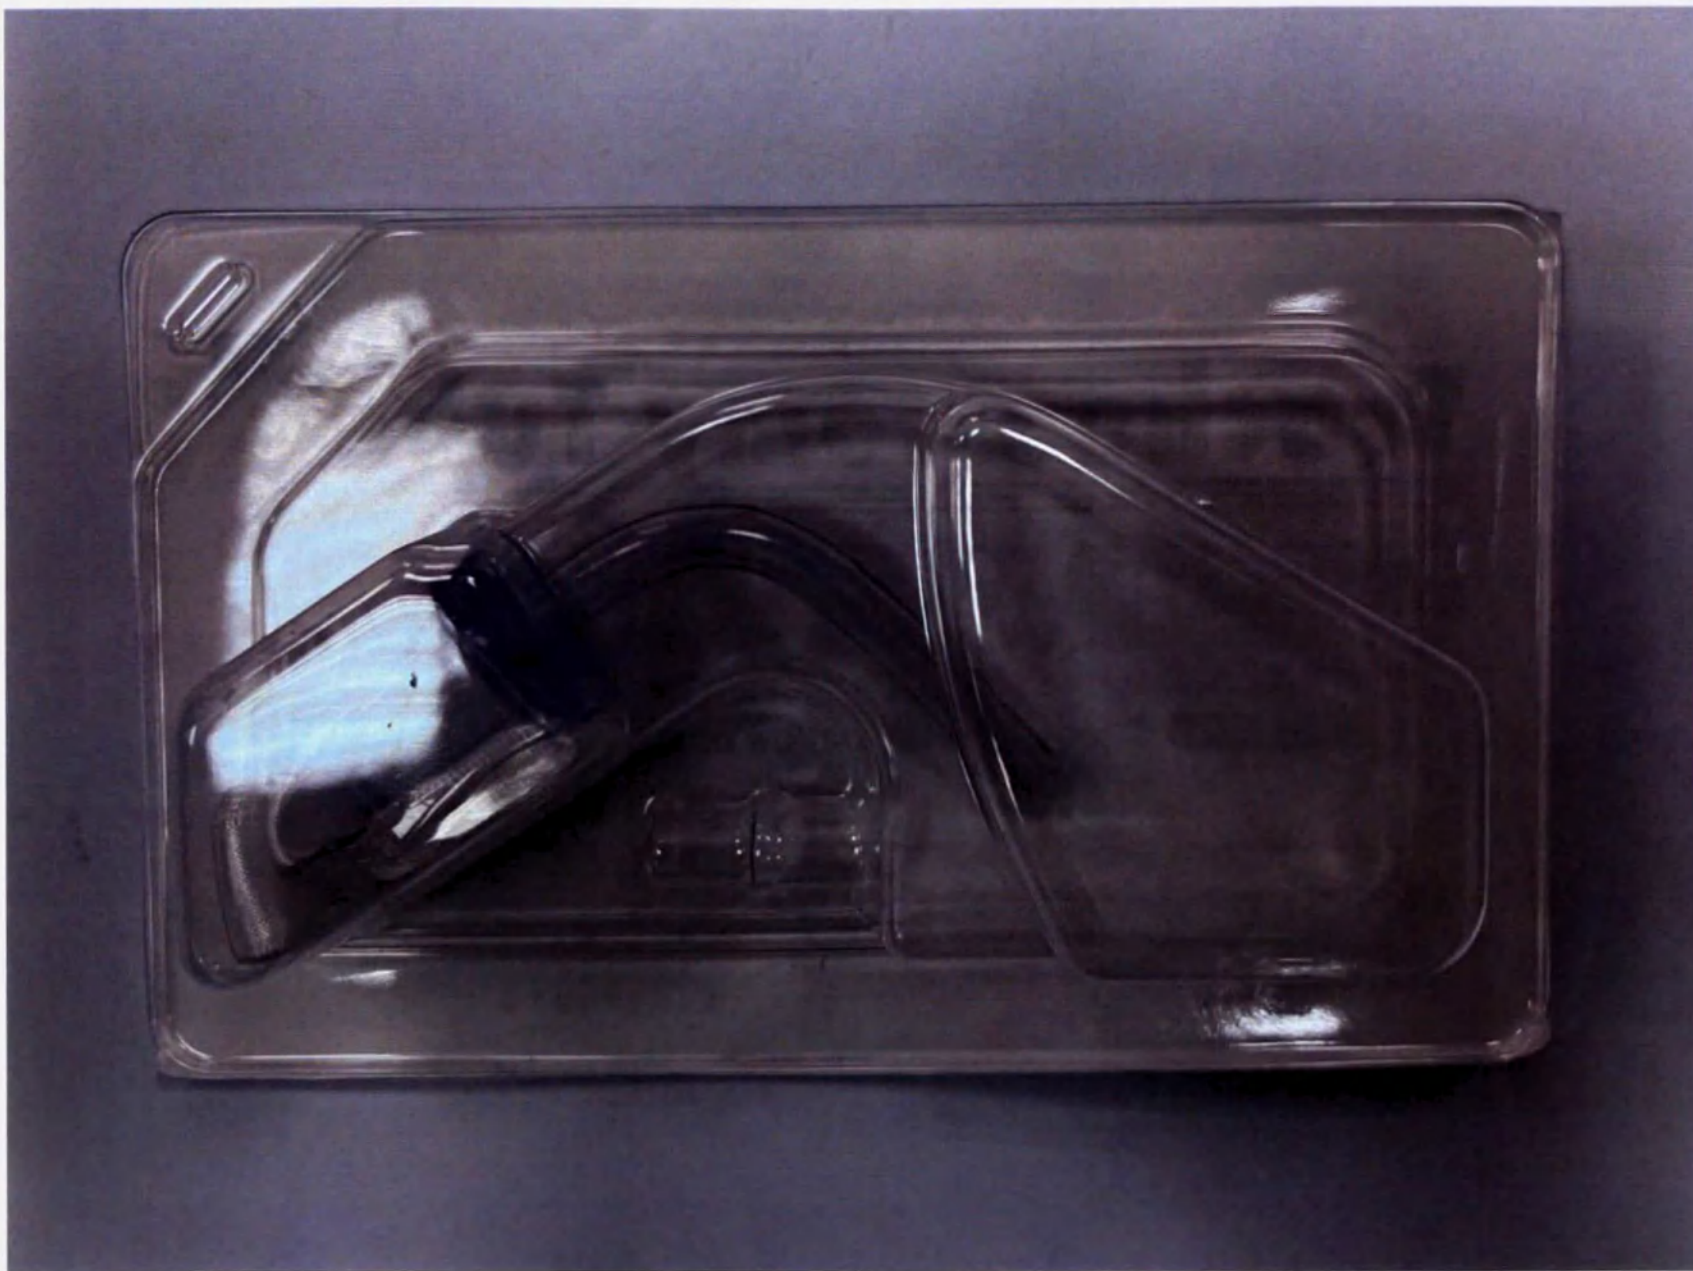

Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 4,0 мм

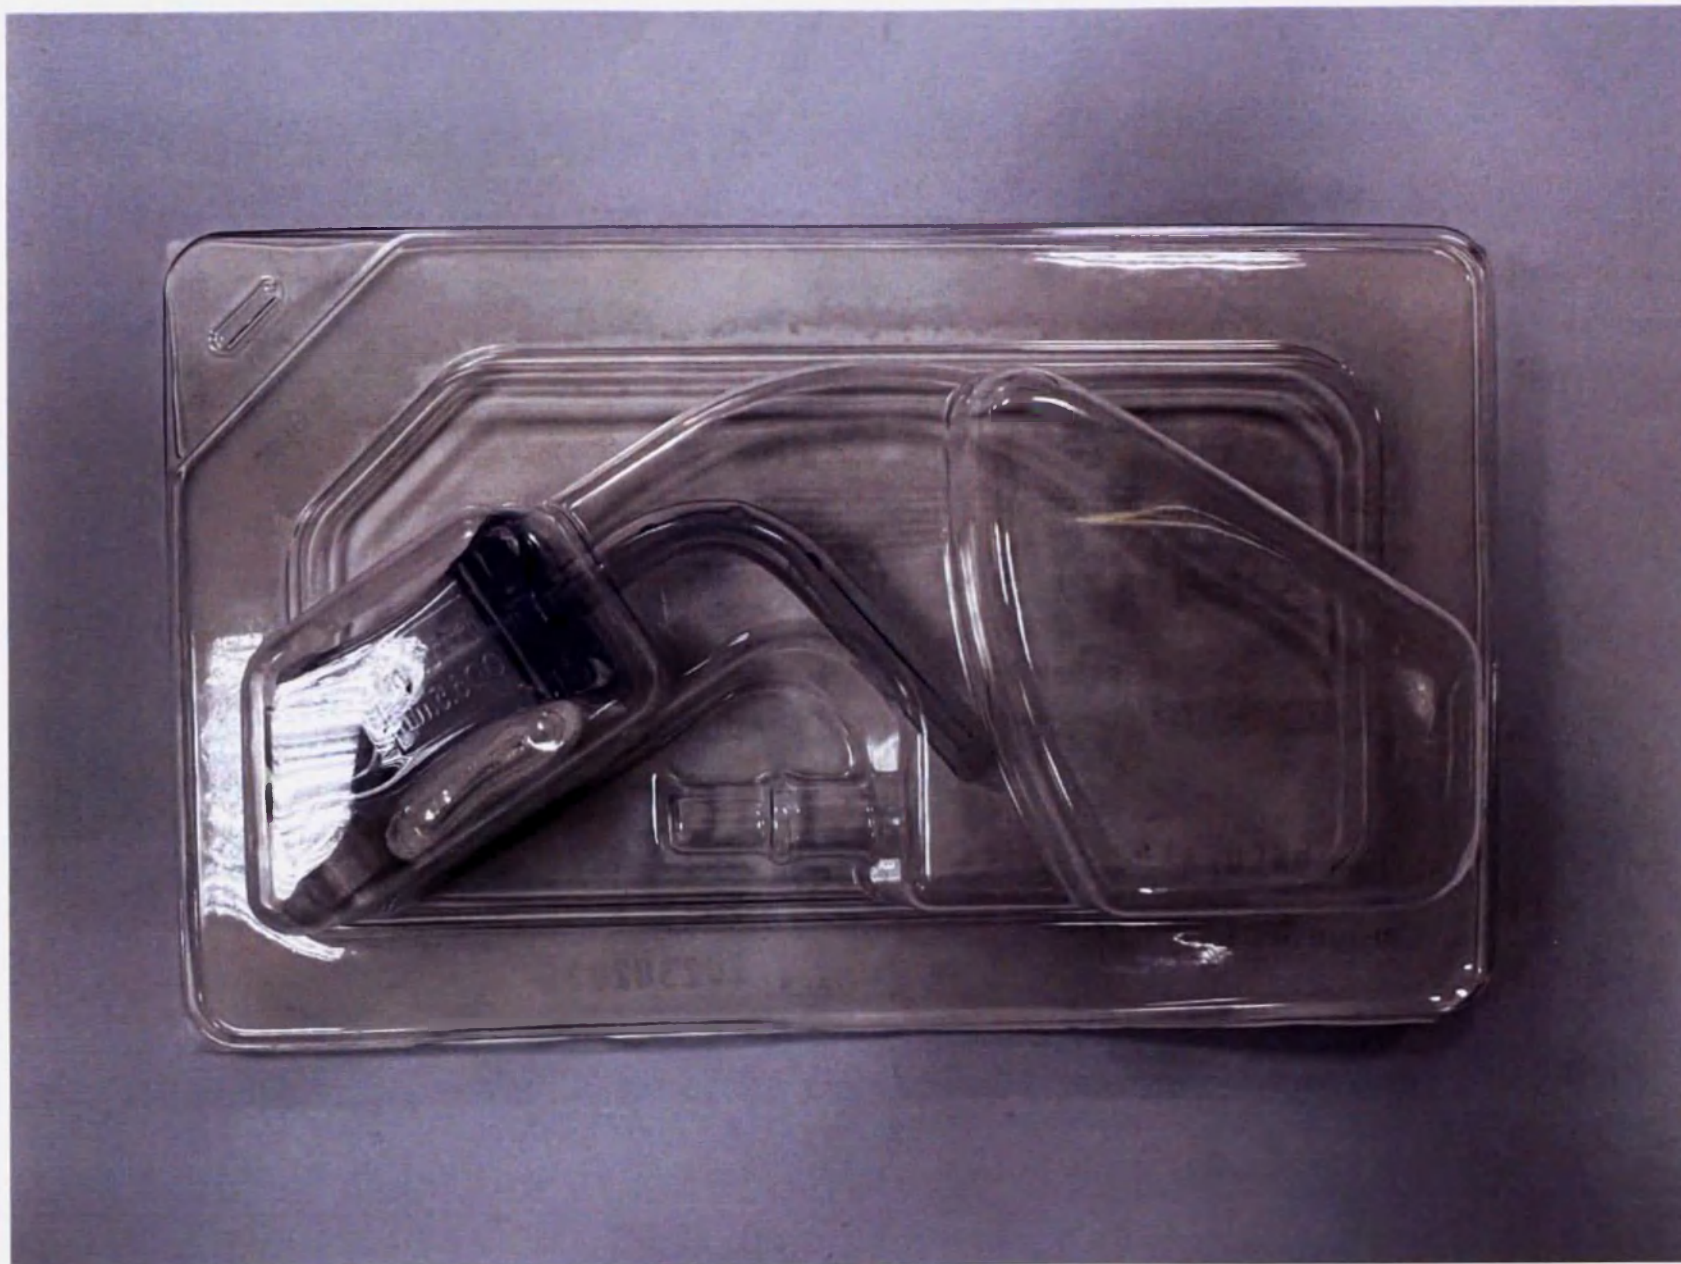


Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 6,0 мм

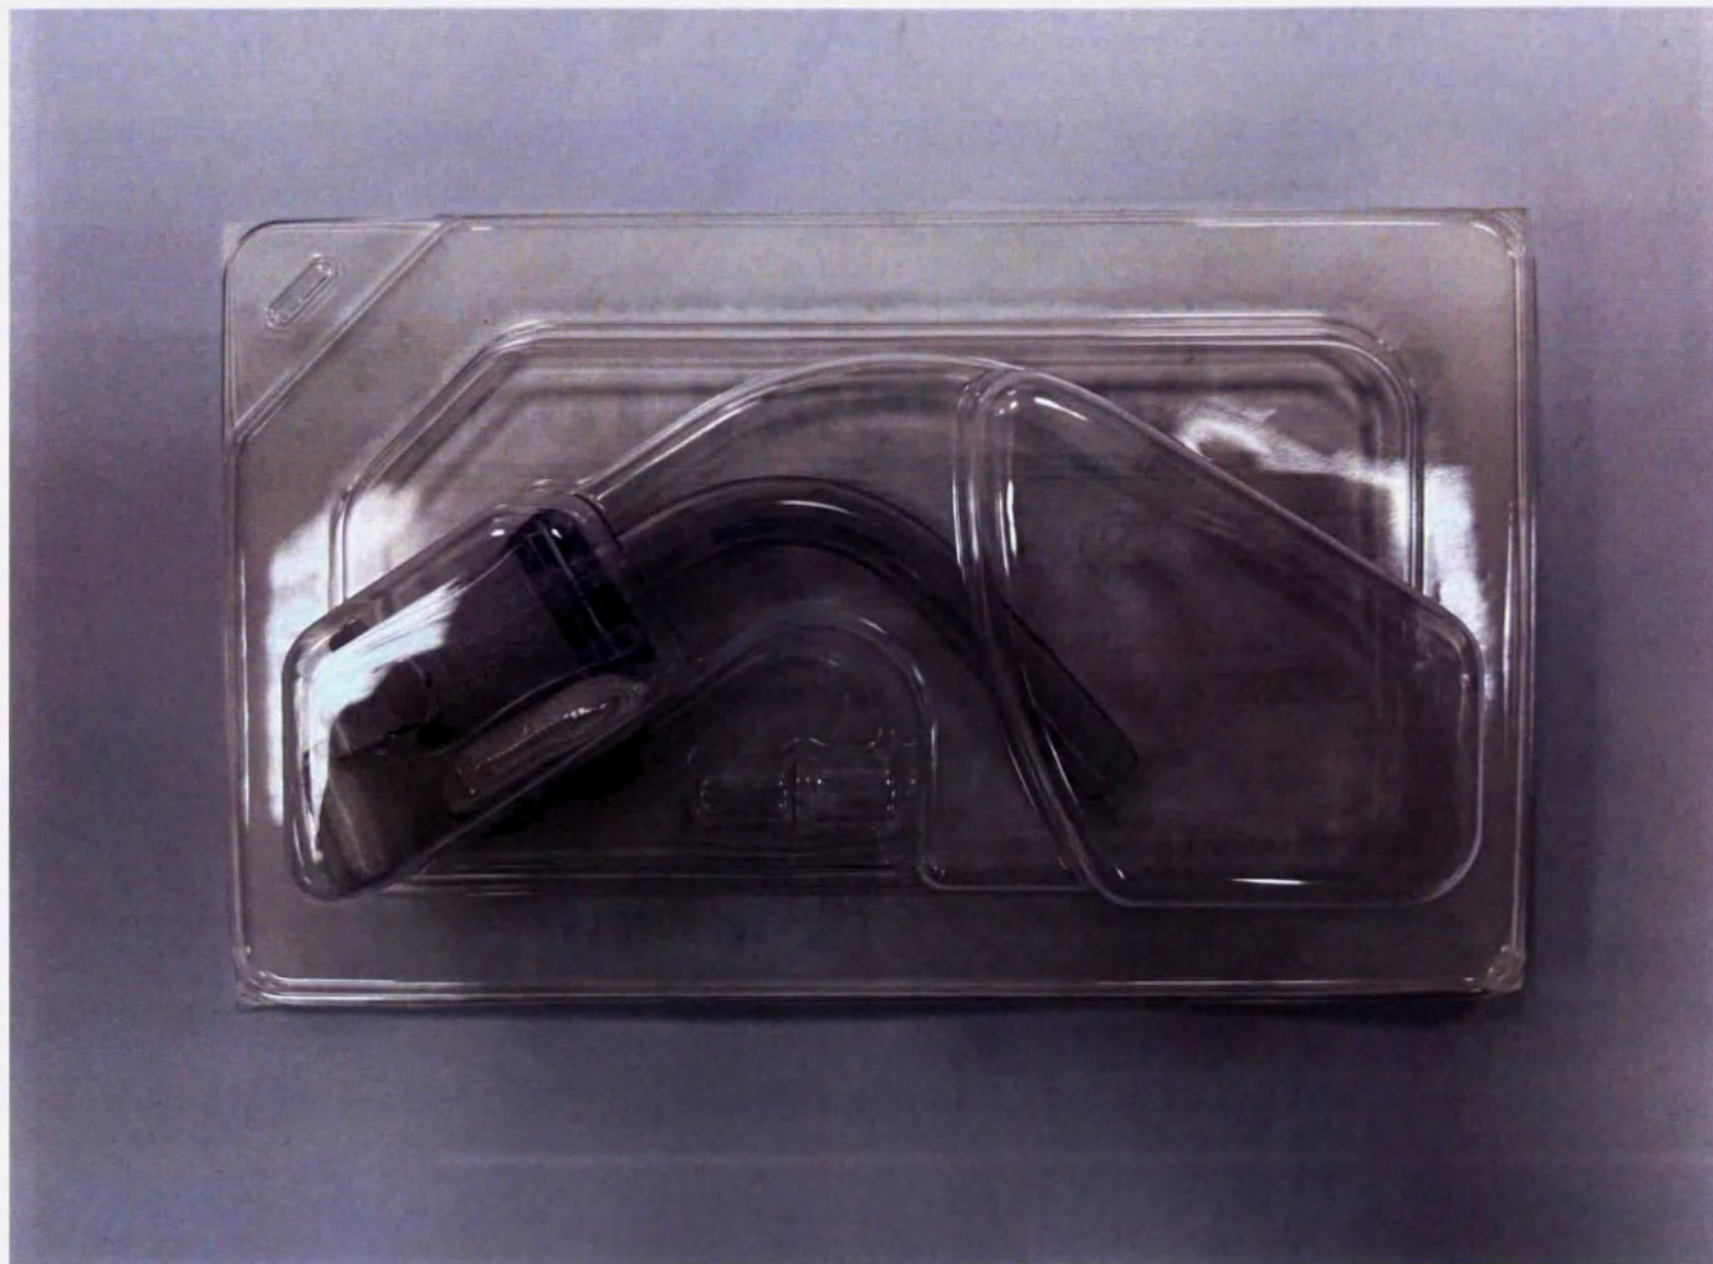


Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 7,0 мм




Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 8,0 мм

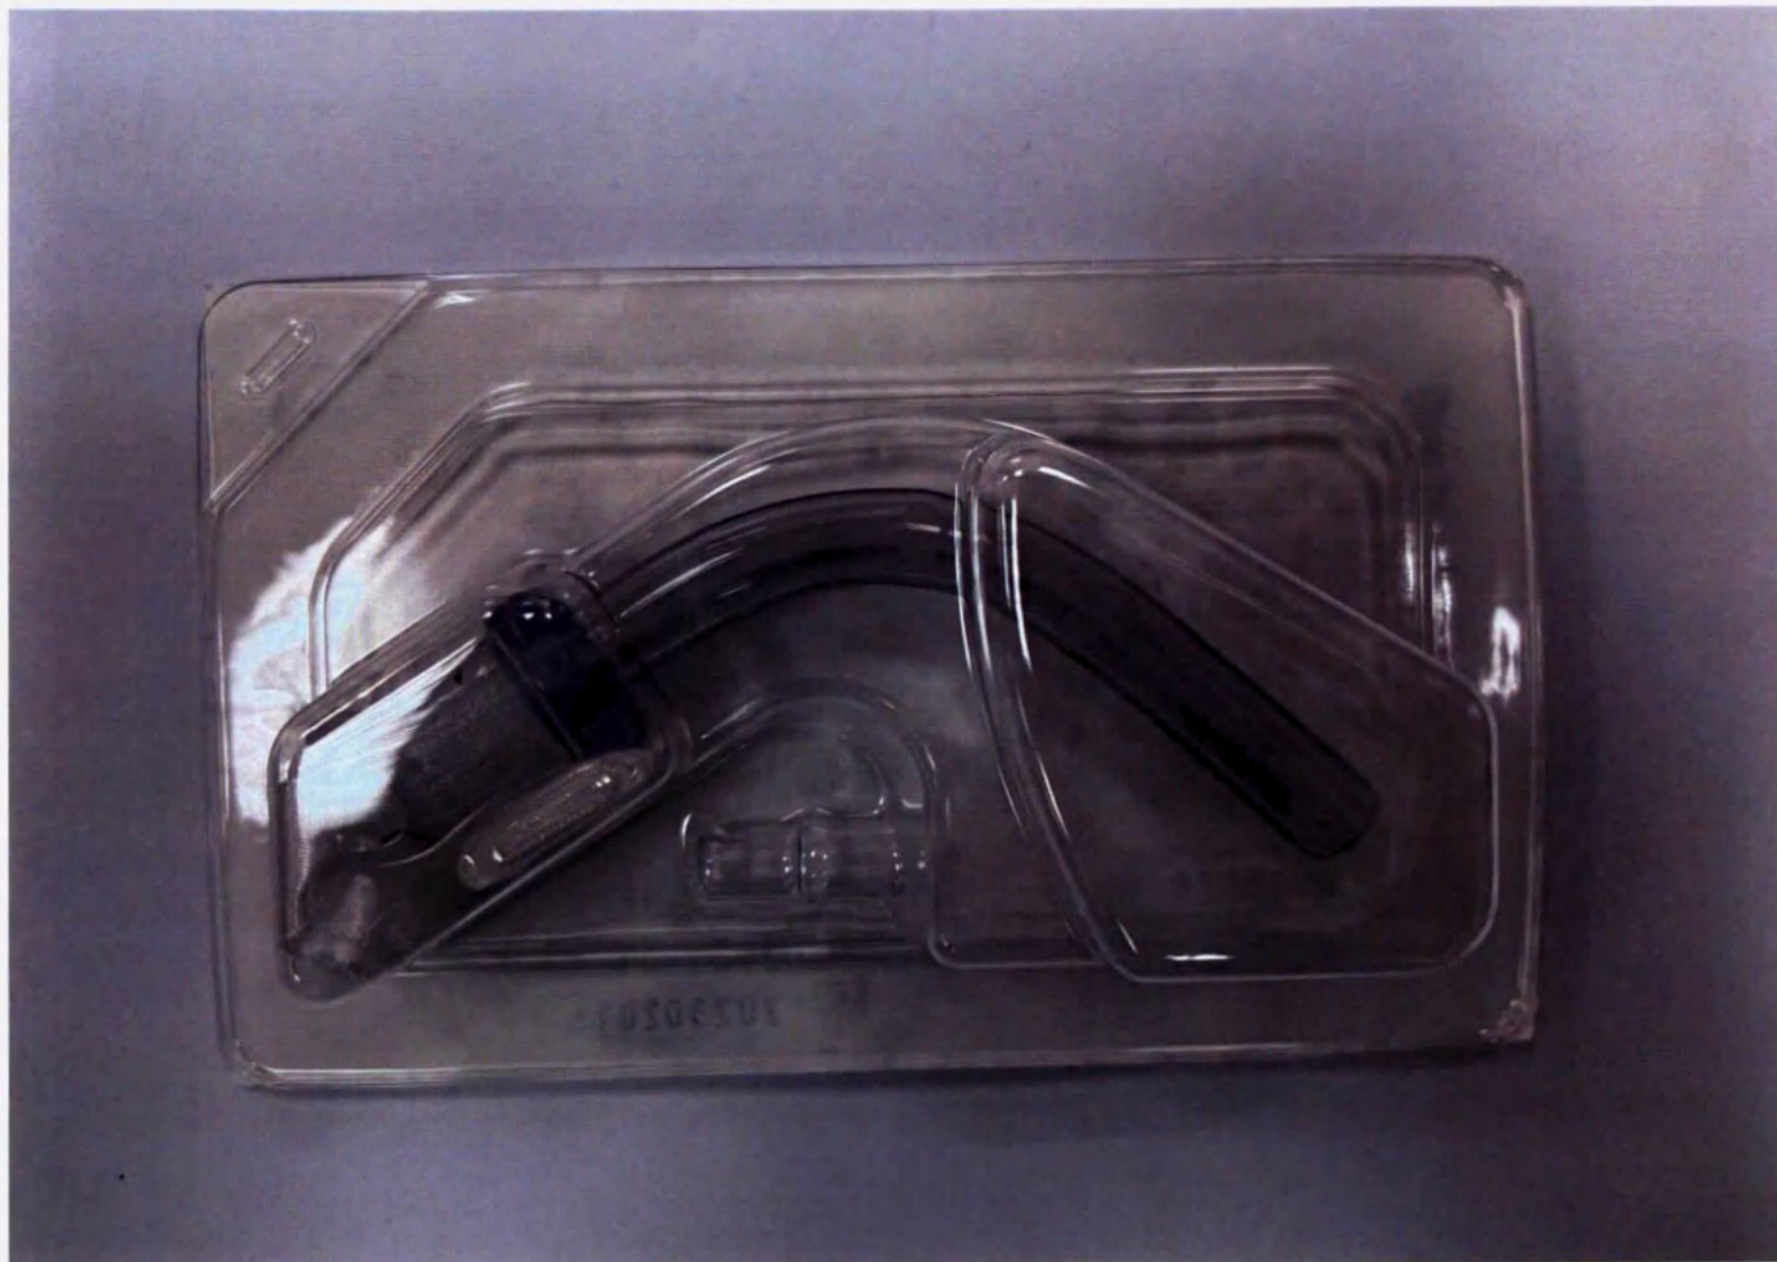


Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 9,5 мм

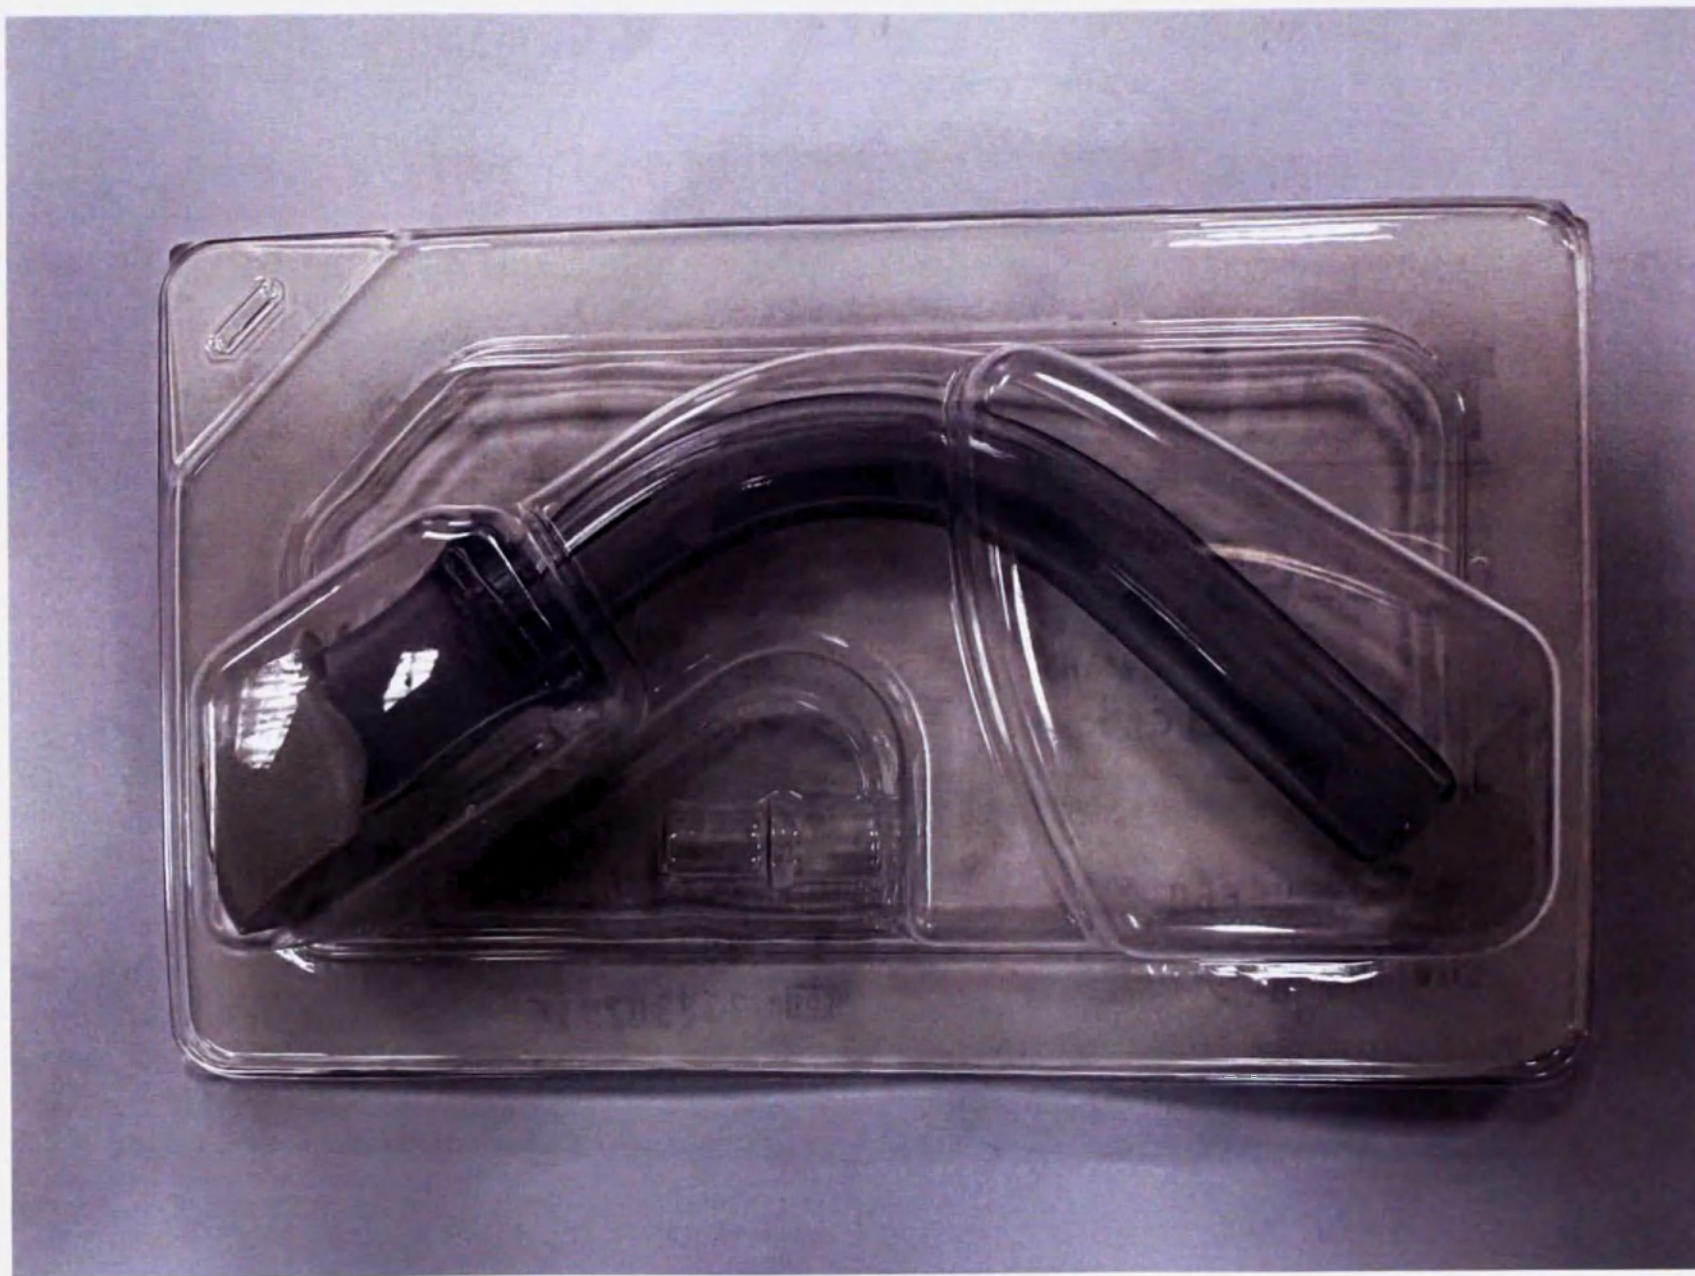

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 5,5 мм

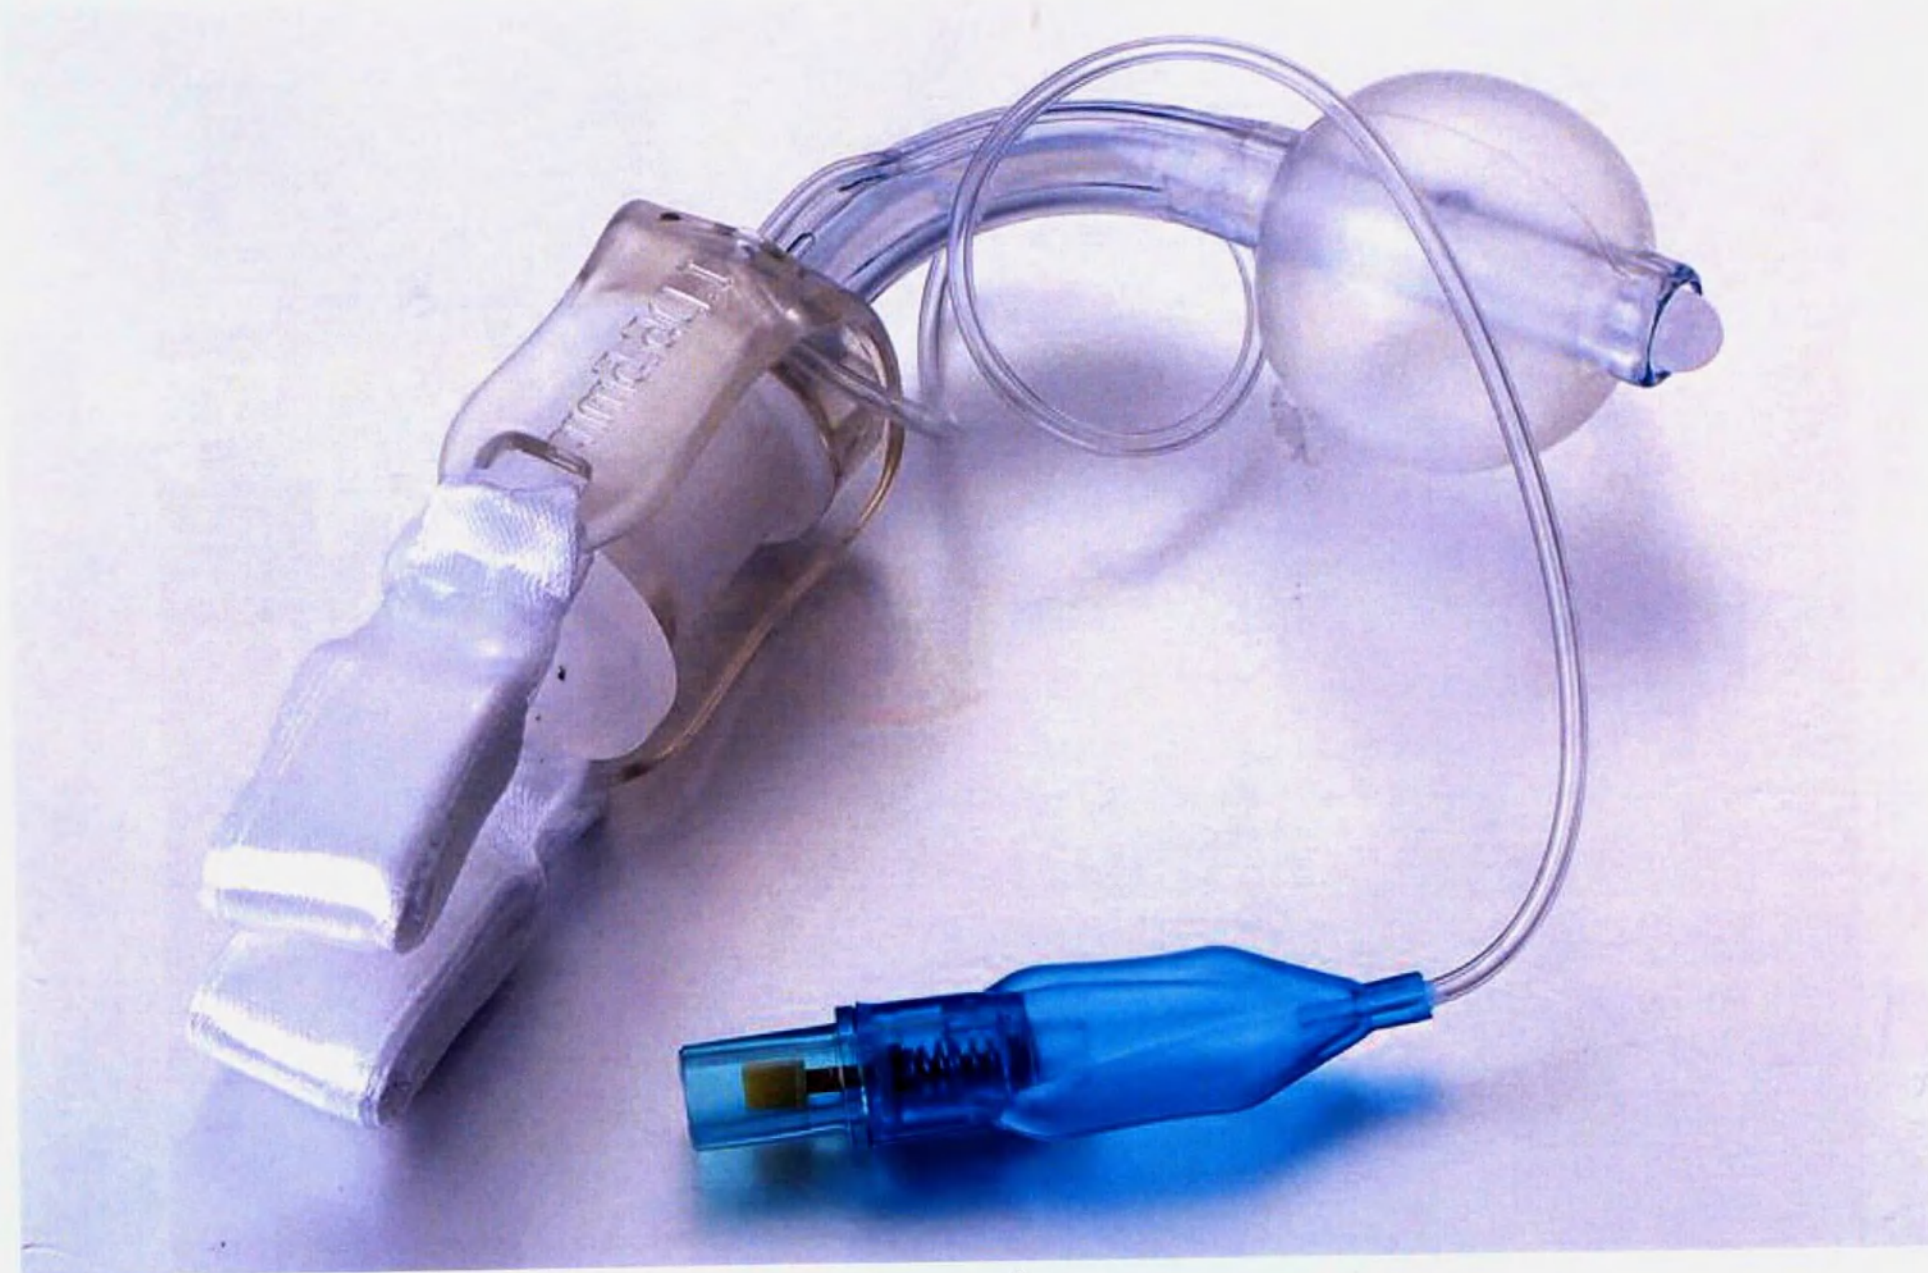


Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 3,5 мм

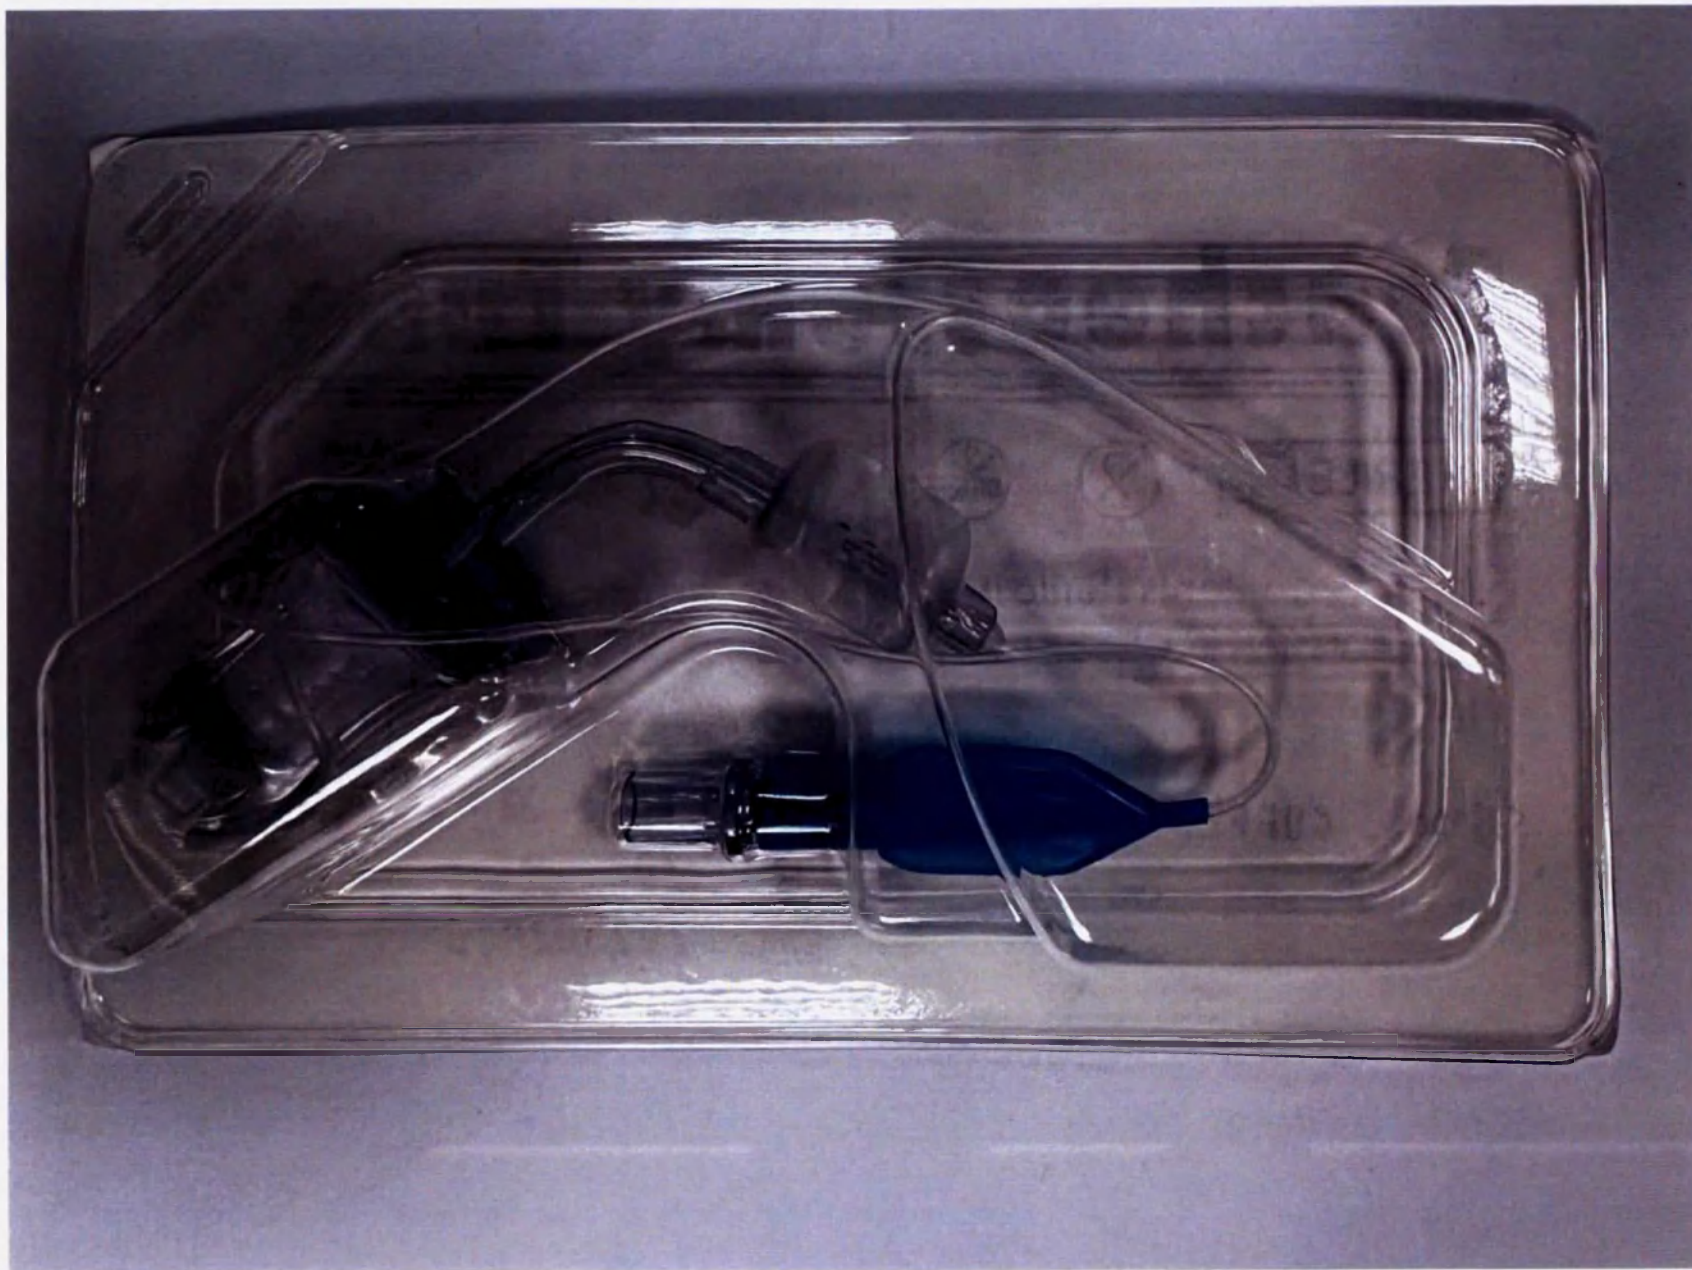


Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 4,5 мм




Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 5,5 мм

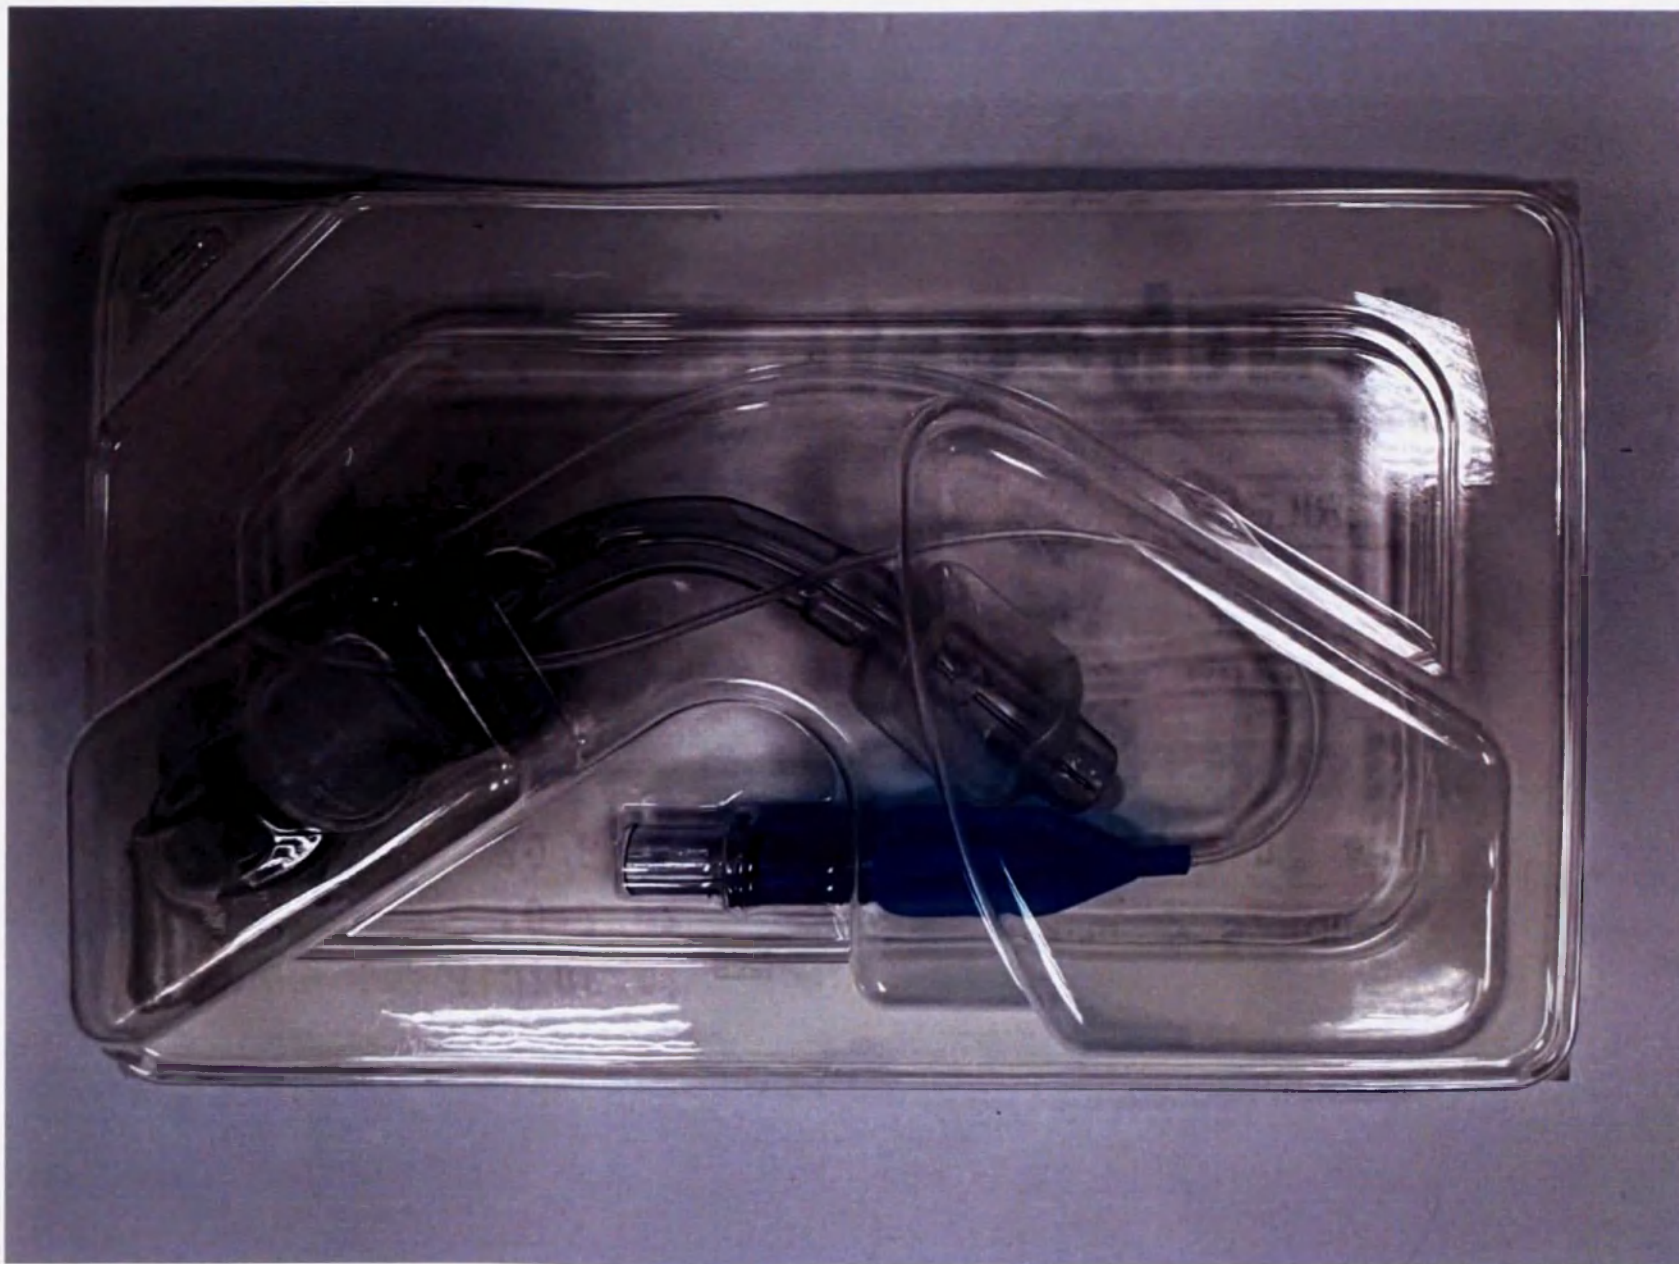


Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 6,5 мм

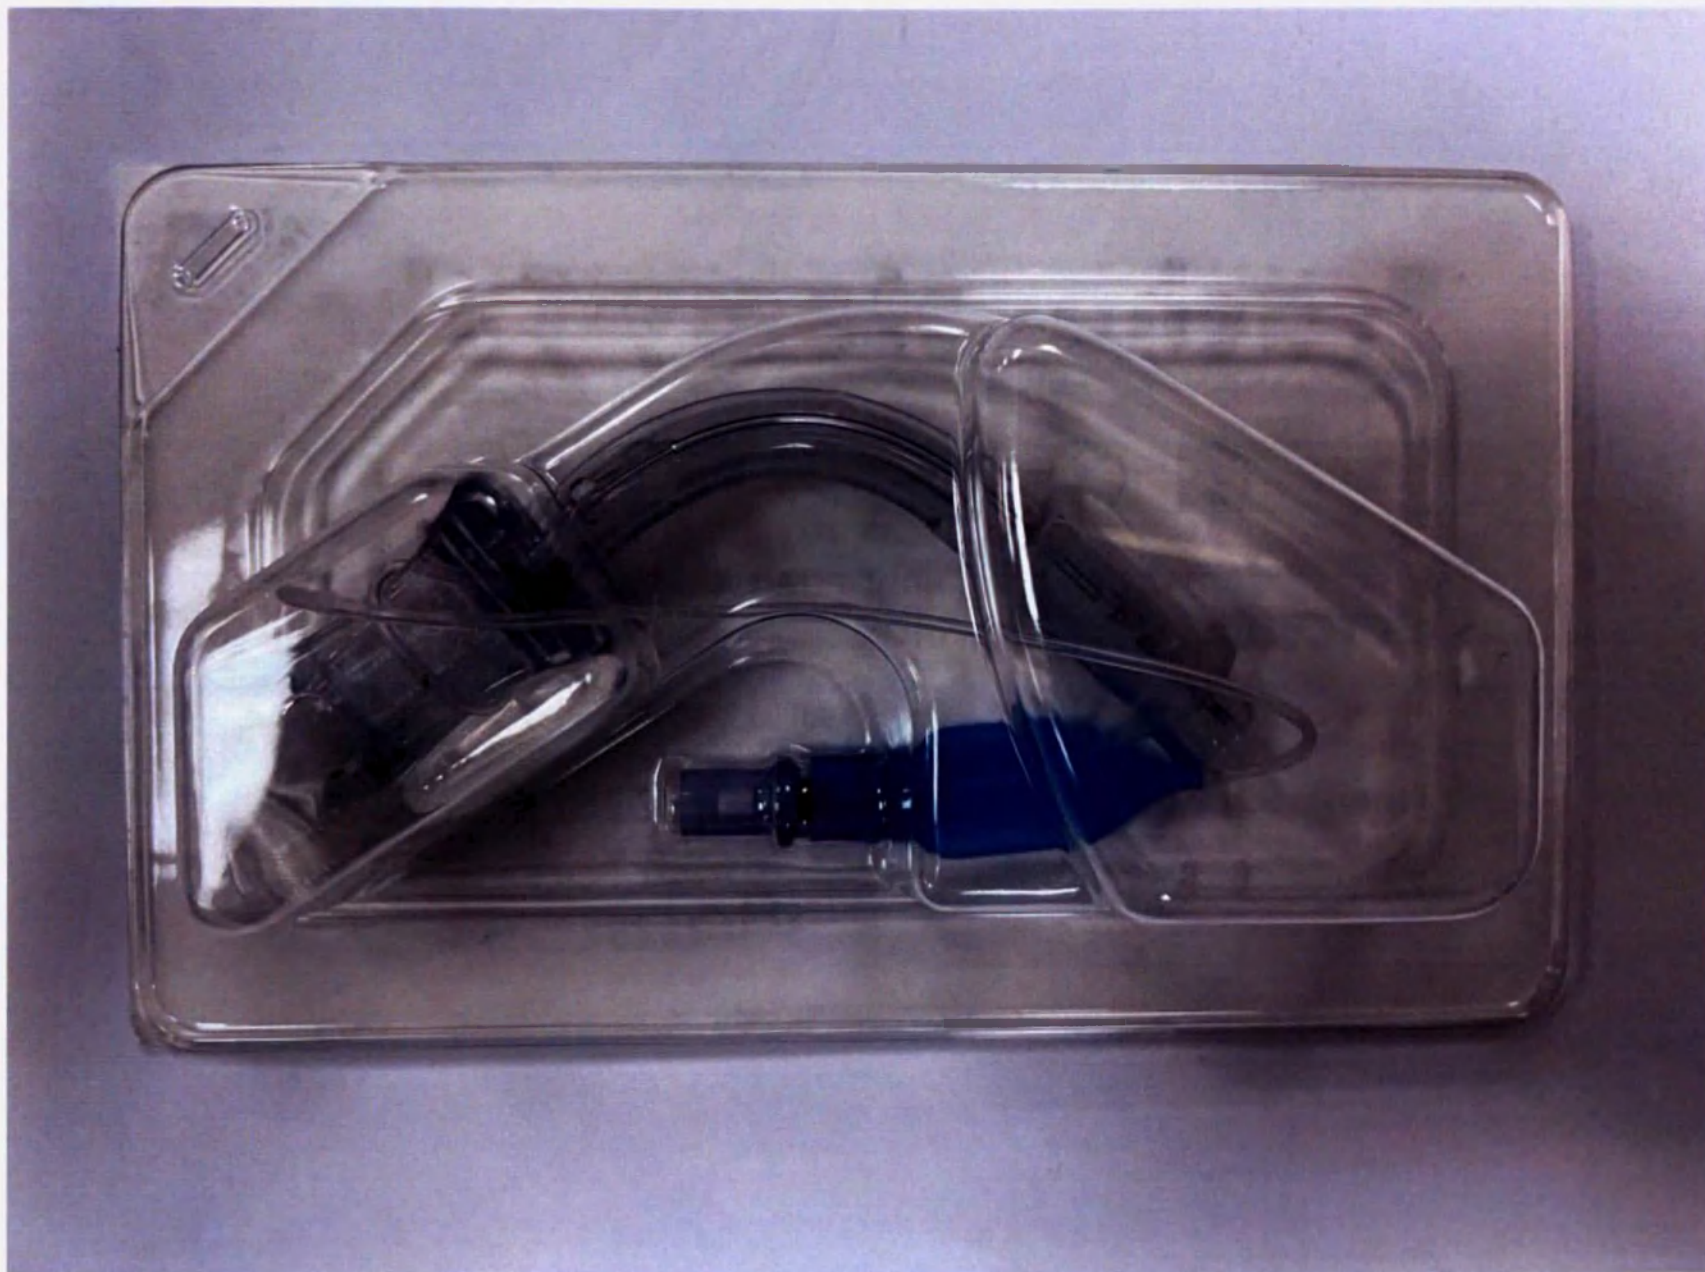


Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 7,5 мм

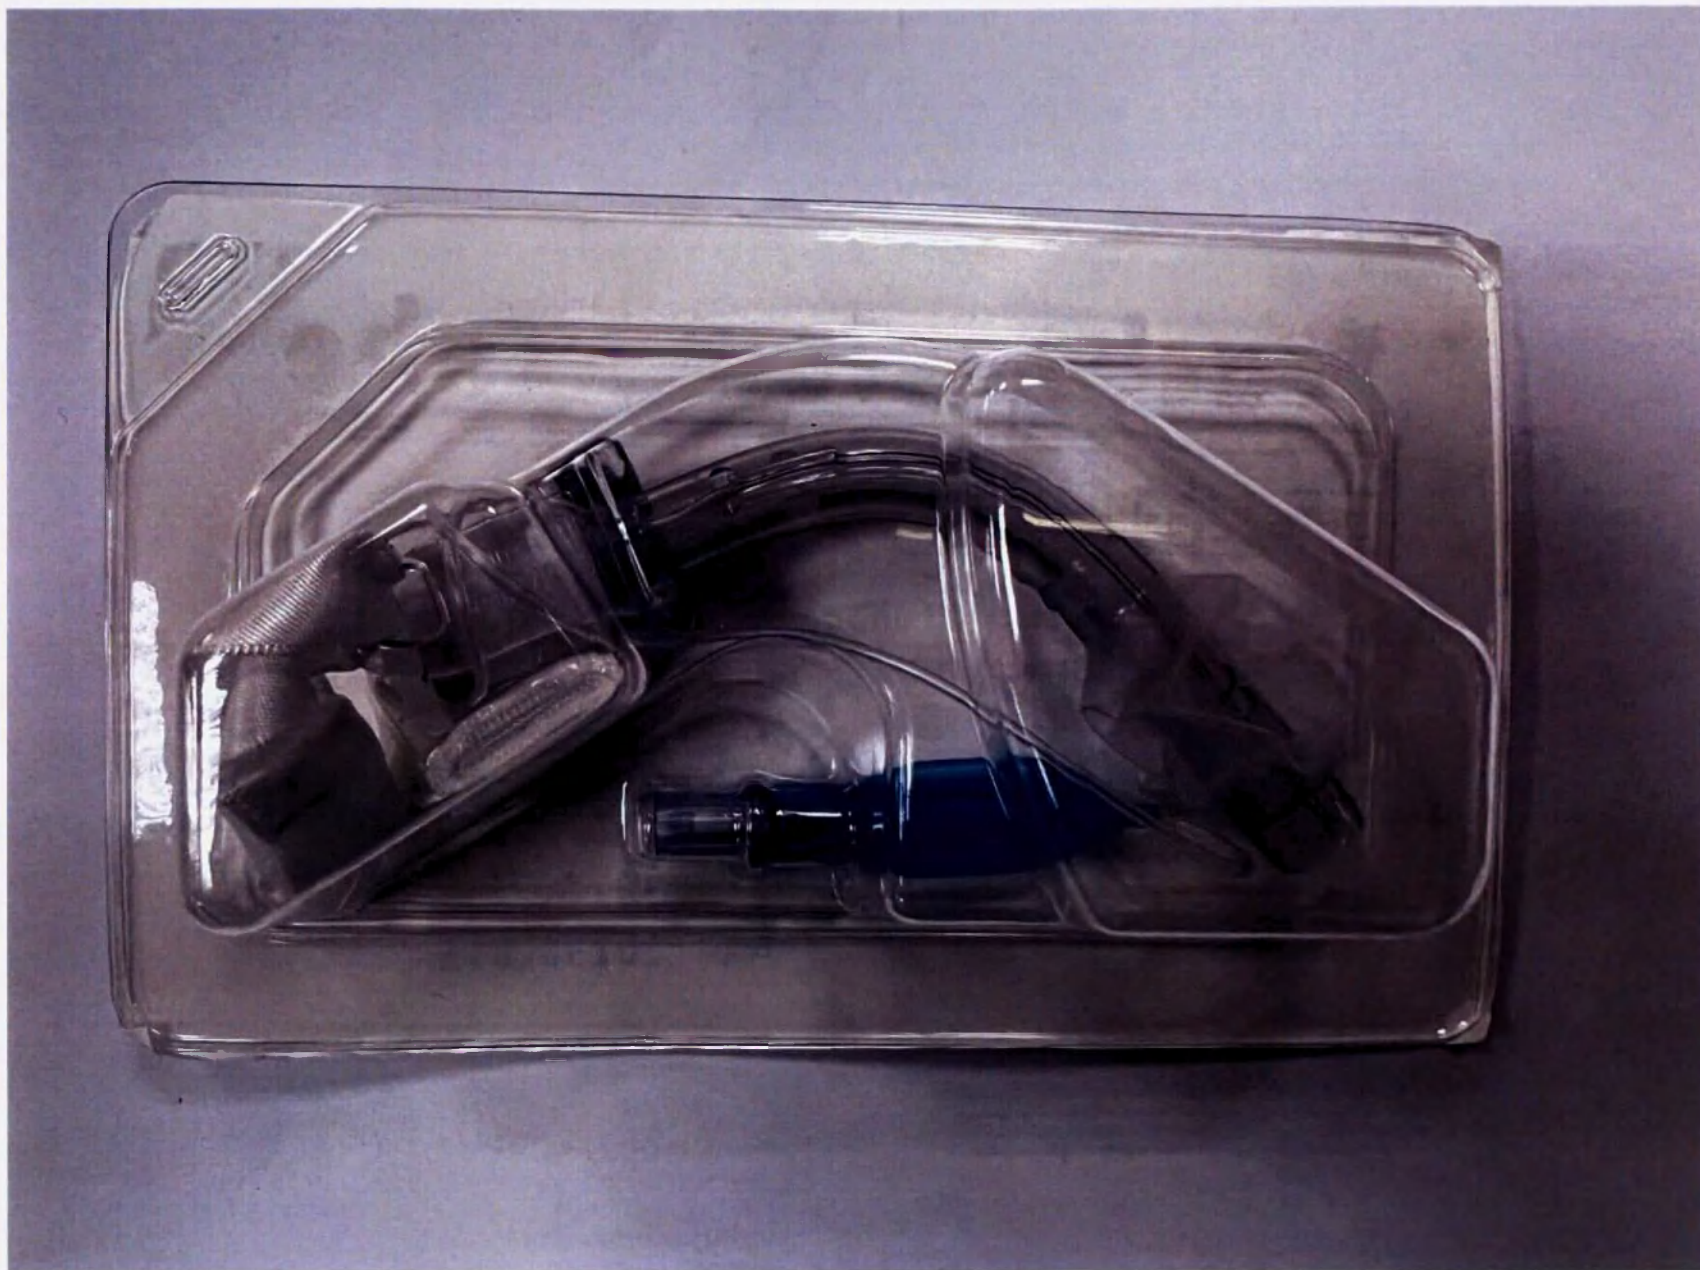

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 8,5 мм

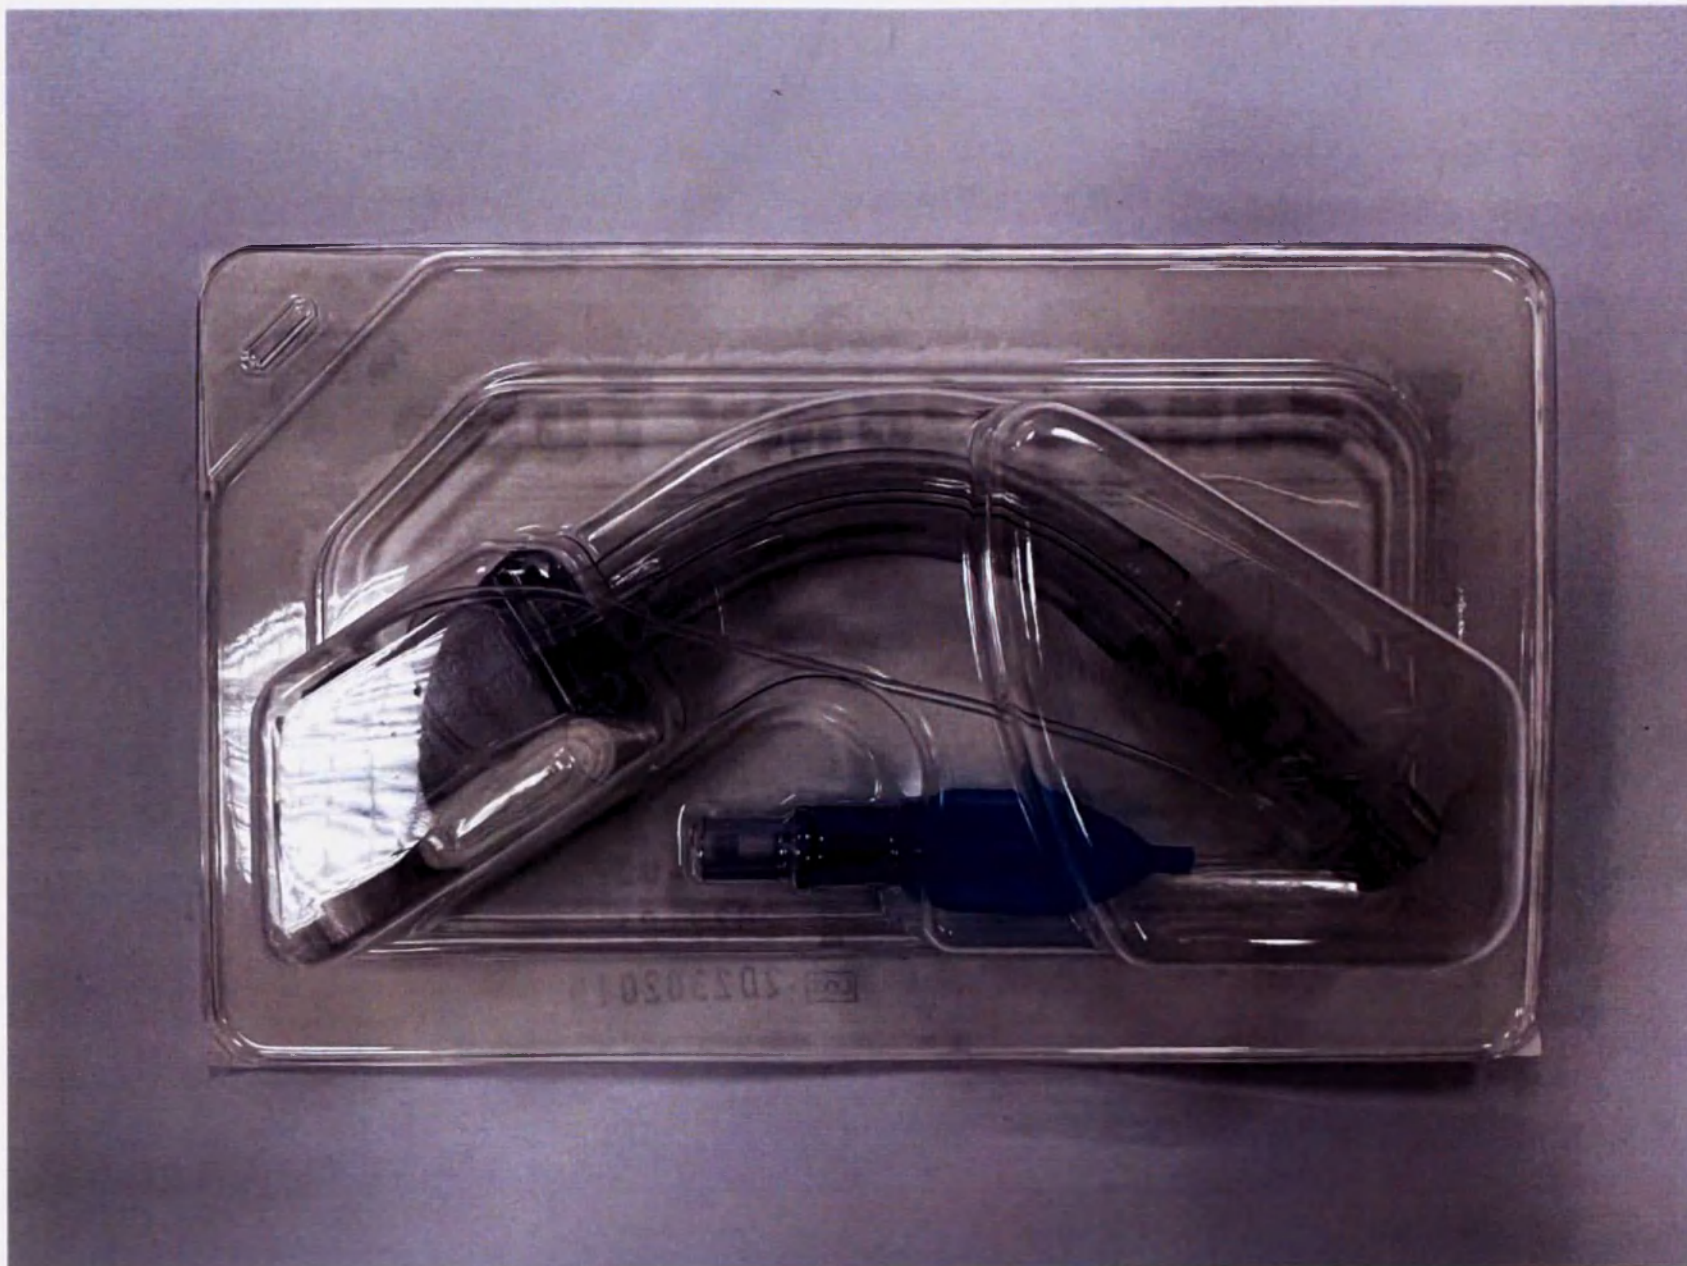


Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 9,5 мм

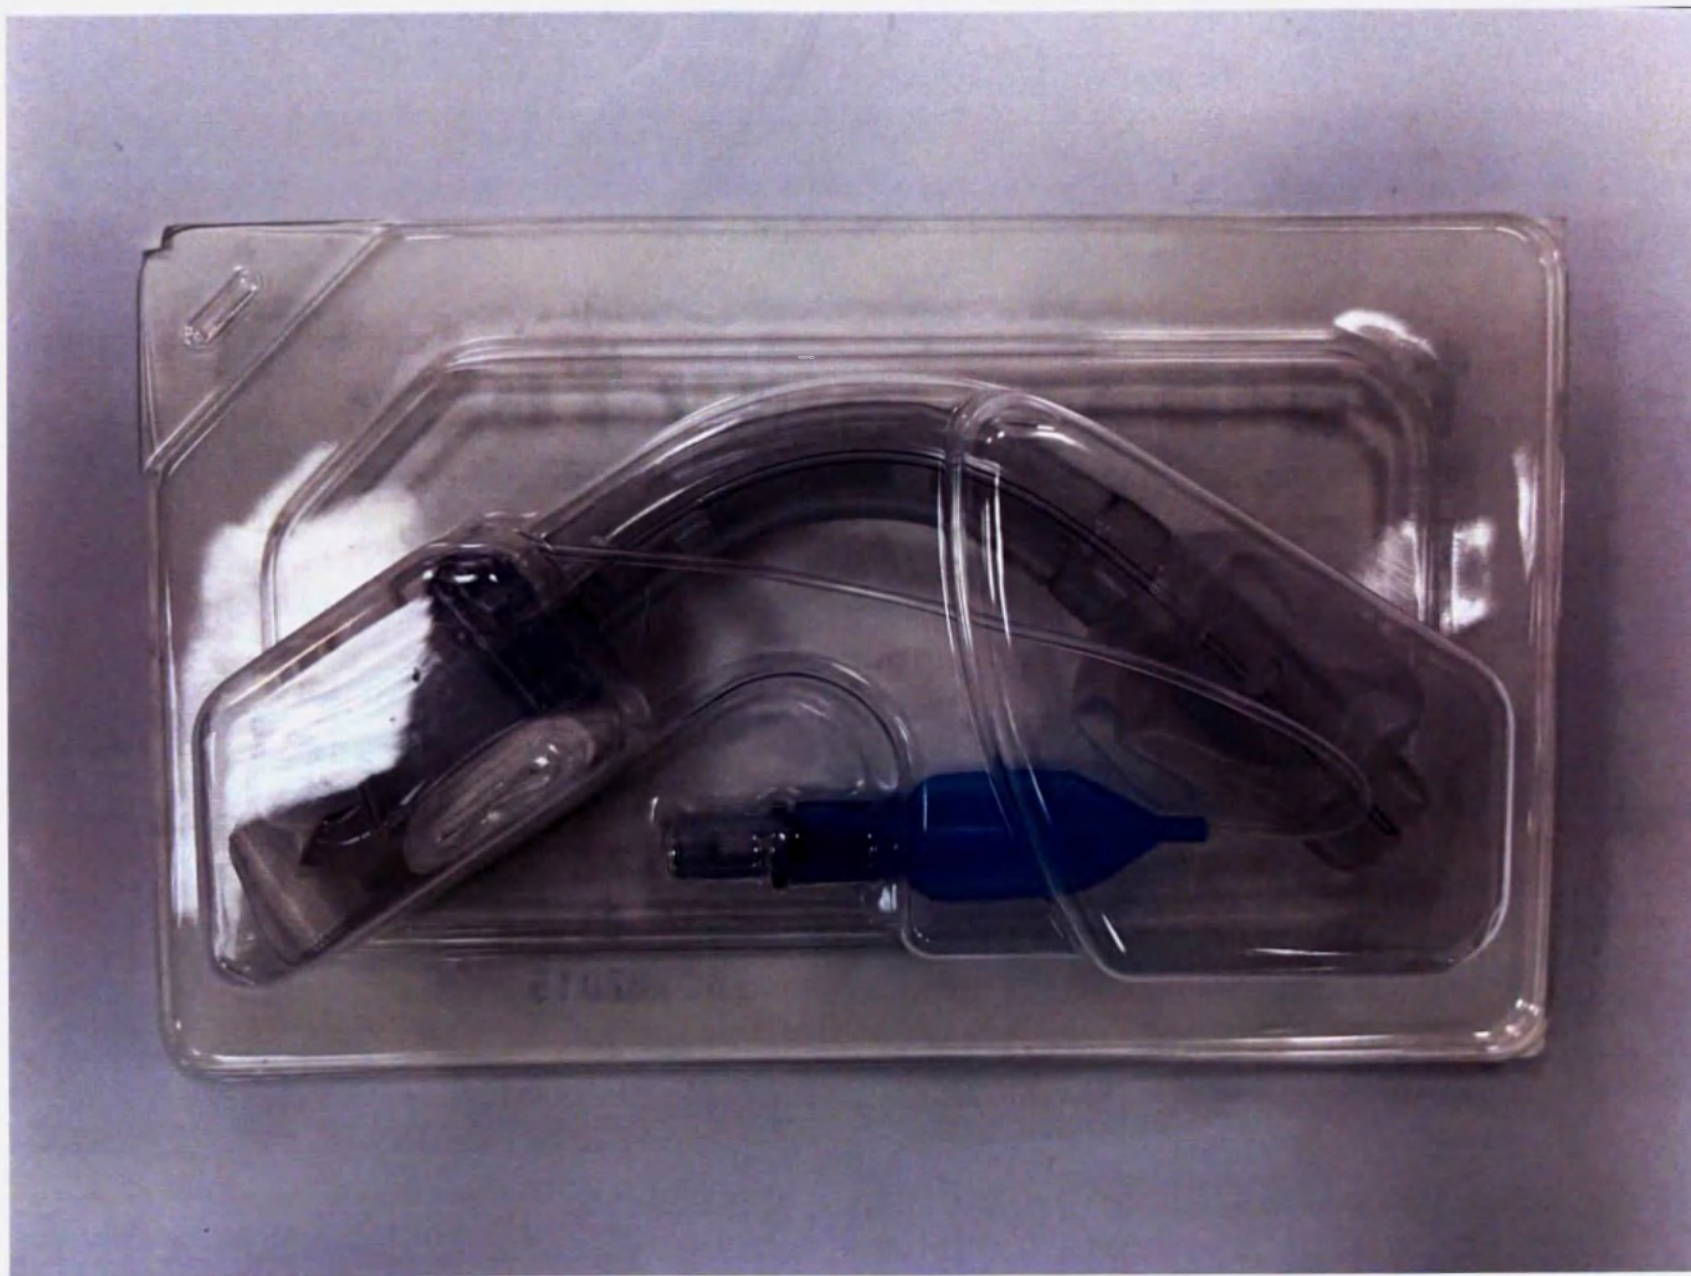

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой и каналом для аспирации, внутренний диаметр 5,5 мм



Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой и каналом для аспирации, внутренний диаметр 8,5 мм

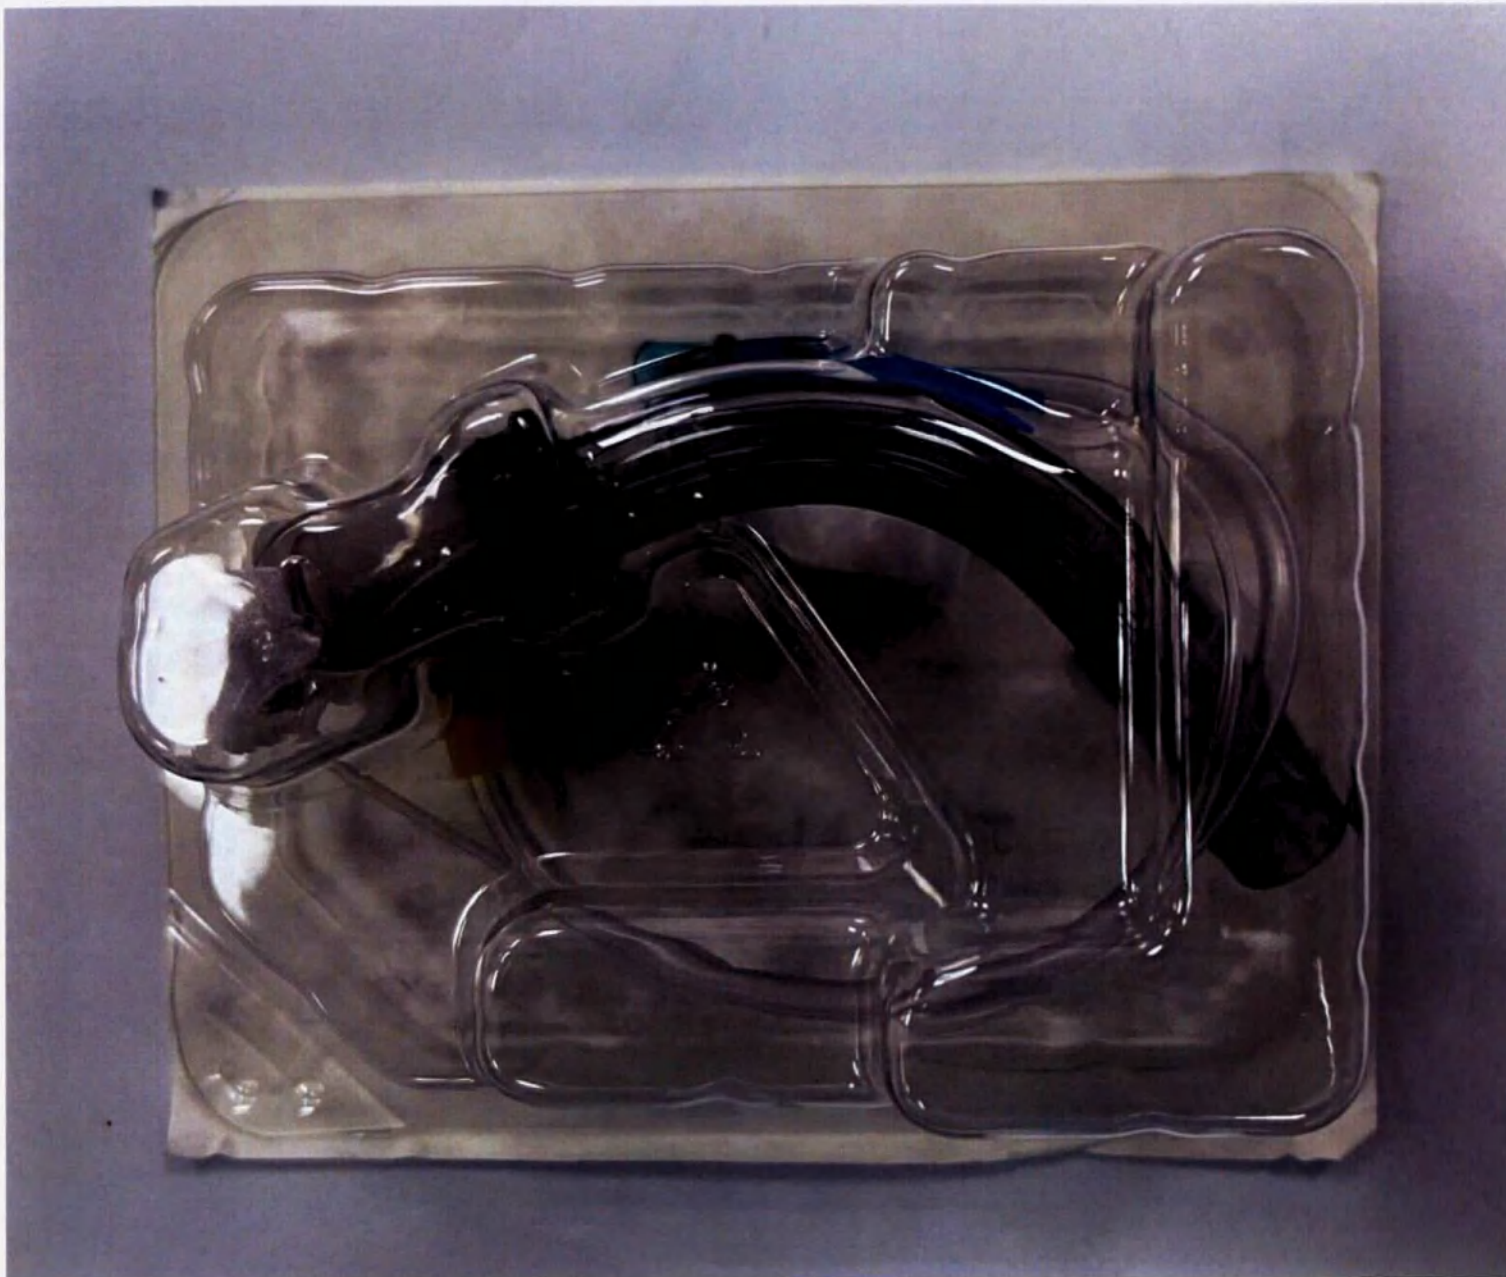

Прошито, пронумеровано и
скреплено 18 листов
ООО «РиГ Групп Ко»
Генеральный директор
/ Г.С. Аллахвердиев
«02» ноября 2023 г



ОКПД2 32.50.13.190

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РиГ Групп Ко»



Г.С. Аллахвердиев/

«2» ноября 2023

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «РиГ Групп Ко»
199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Санкт-Петербург,
2023

Транспортная упаковка

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 8,5 мм – X шт.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительная влажность не более 100% при плюс 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXXXXX

REF

XXXXXXXXXX



Индивидуальная упаковка

1) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 3,5 мм

Трубка трахеостомическая STATIM, одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 3,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «РиГ Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511035C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

2) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 4,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 4,0 мм – 1 штука.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «РиГ Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511040C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

3) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 4,5 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 4,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «Риг Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511045C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



ПУ №от.....

4) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 5,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 5,0 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «Риг Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511050C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

5) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 5,5 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 5,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511055C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

6) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 6,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 6,0 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511060C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы I (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

7) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 6,5 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 6,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «Риг Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511065C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

8) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 7,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 7,0 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «Риг Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511070C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

9) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 7,5 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 7,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «Риг Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511075C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

10) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 8,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 8,0 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «Риг Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028

LB511080C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

11) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 8,5 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 8,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «Риг Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511085C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

12) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 9,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 9,0 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «Риг Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511090C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



ПУ №от.....

13) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 9,5 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 9,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511095C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении → по классу отходов А.



РУ №от.....

14) Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 10,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM с манжетой, внутренний диаметр 10,0 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB5110100C

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

15) Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 3,5 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 3,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511035

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

16) Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 4,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 4,0 мм – 1 штука.



Адрес места
производства:

ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511040

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

17) Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 4,5 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 4,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511045

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

18) Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 5,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 5,0 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «Риг Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1
Bonree Medical Co., Ltd.
No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511050

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

19) Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 6,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 6,0 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «Риг Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511060

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы I (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

20) Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 7,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 7,0 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «Риг Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511070

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

21) Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 7,5 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 7,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511075

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

22) Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 8,0 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 8,0 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «Риг Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511080

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

23) Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 8,5 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 8,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «Риг Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511085

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



ПУ №от.....

24) Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 9,5 мм

**Трубка трахеостомическая STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-012-38044224-2023**

Трубка трахеостомическая STATIM без манжеты, внутренний диаметр 9,5 мм – 1 штука.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Bonree Medical Co., Ltd.

No. 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang, 528451 Zhongshan, Guangdong, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA



02.2023



202302015



01.2028



LB511095

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.




РУ №от.....

Прошито, пронумеровано и
скреплено 26 листов

ООО «РиГ Групп Ко»

Генеральный директор

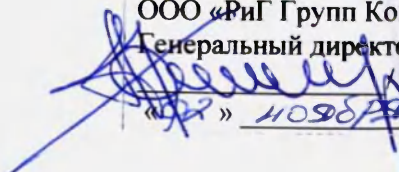 А.С. Аллахвердиев

«02» ноября 2023 г.

