

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Носова Т.А.

М.П.

« 22 » августа 2023 г.




МИТРОХИНА Ю.Ю.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АД6134547

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Катетер доставки Benchmark


Penumbra, Inc. («Пенумбра, Инк.»), Соединенные Штаты Америки

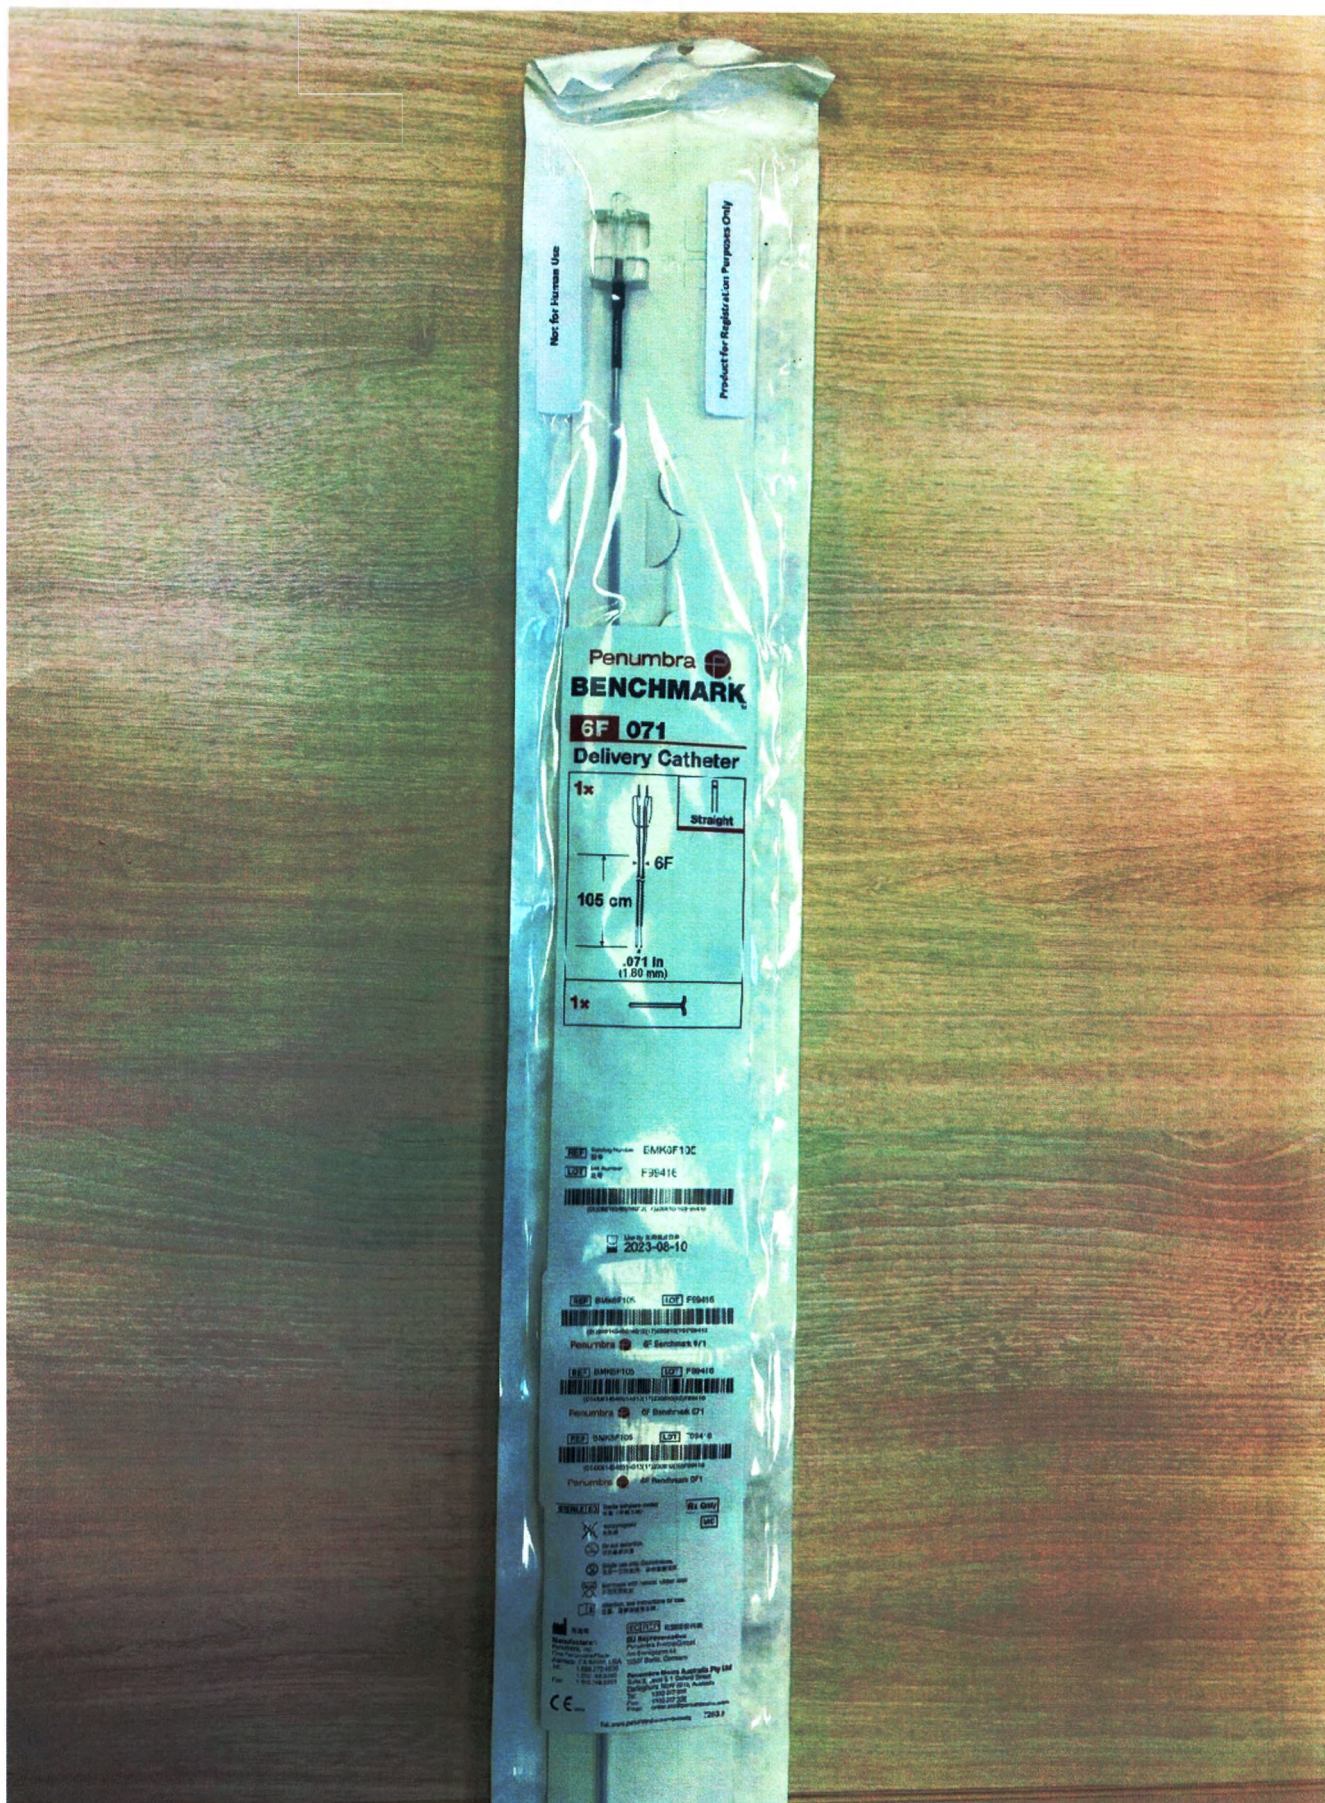

Индивидуальная упаковка с оригинальной маркировкой. Катетер доставки Benchmark
Вариант исполнения: BMK6F105 (для других вариантов исполнения – аналогично)




**Потребительская упаковка с оригинальной маркировкой. Катетер доставки Benchmark
Вариант исполнения: BMK6F105 (для других вариантов исполнения – аналогично)**

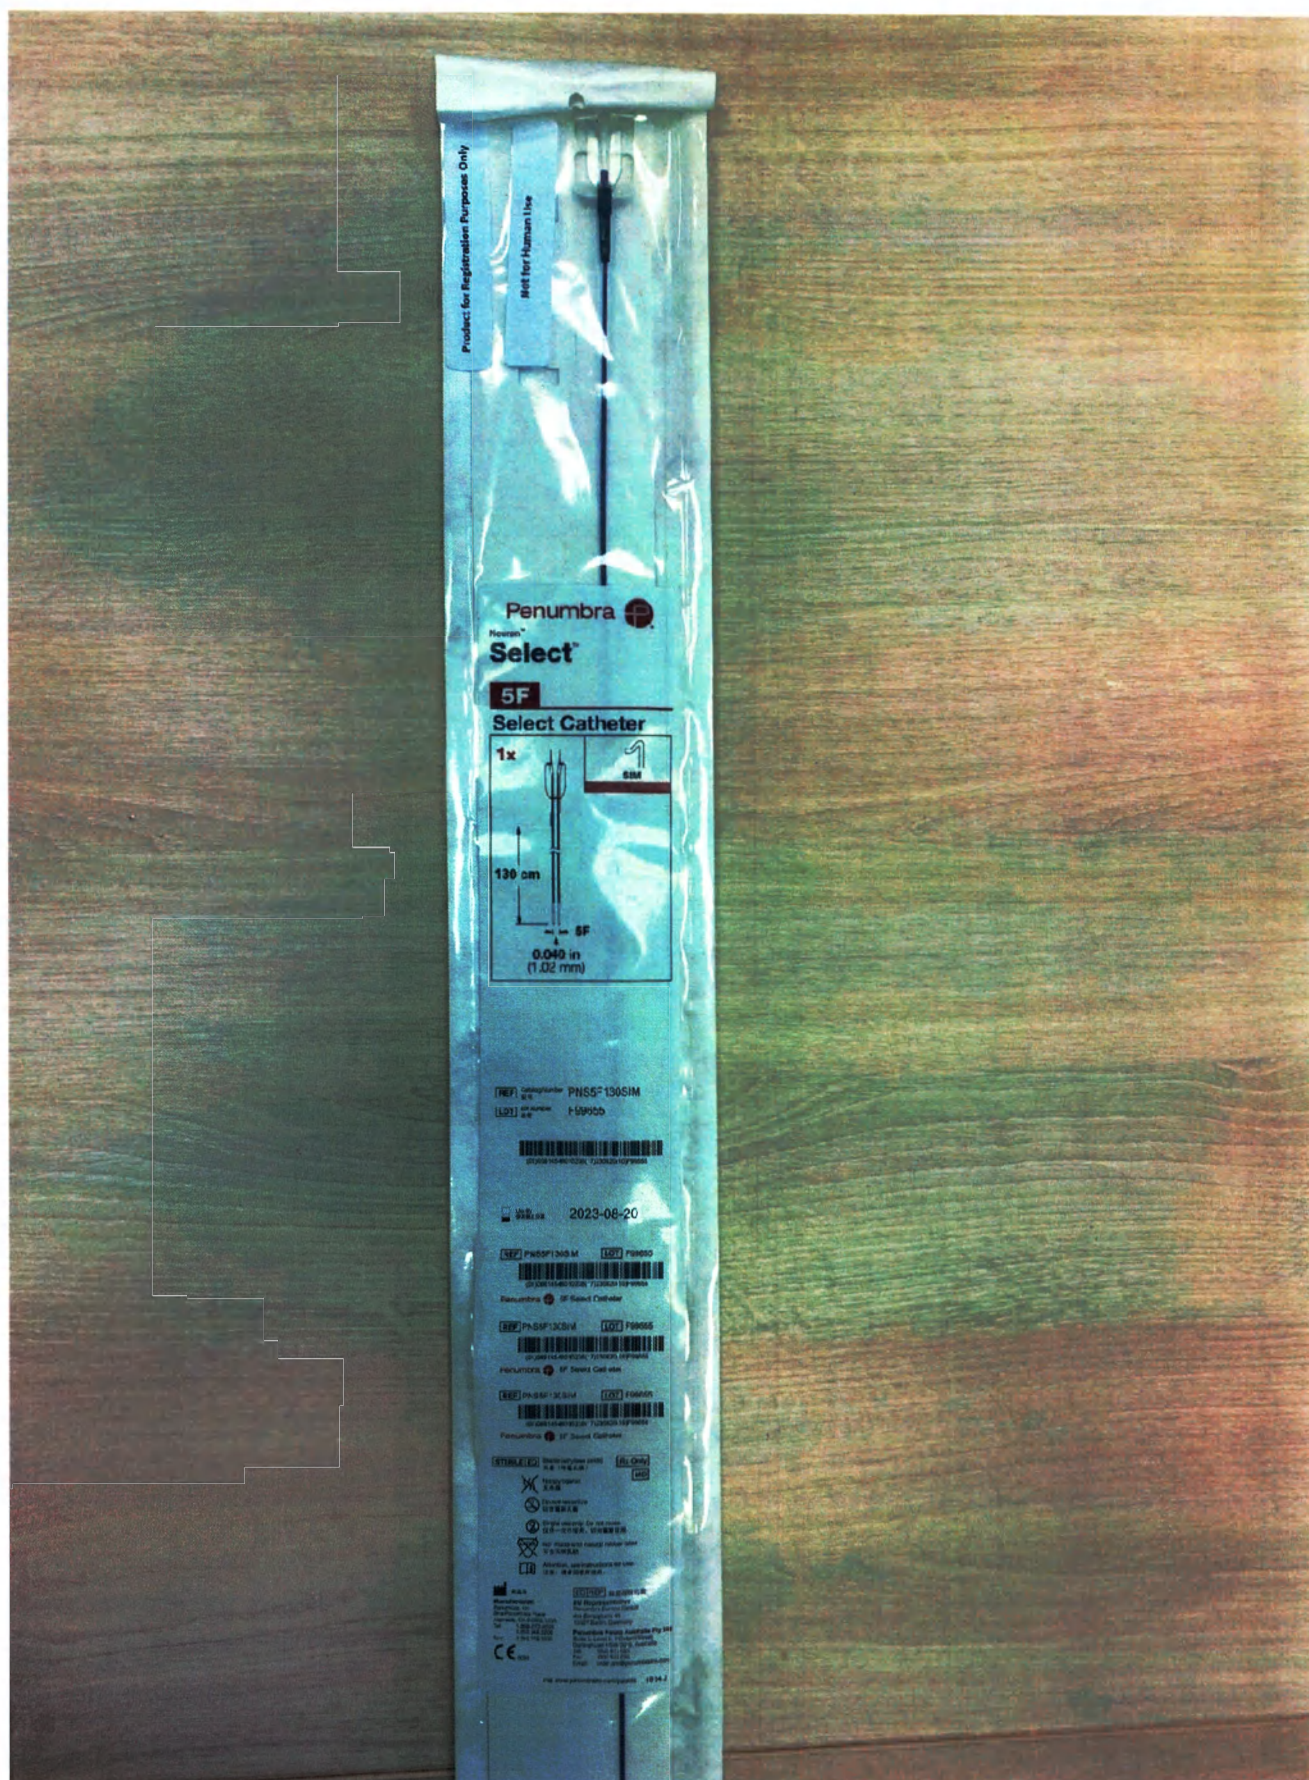

Индивидуальная упаковка с оригинальной маркировкой. Катетер доставки Benchmark
Вариант исполнения: PNS5F130SIM (для других вариантов исполнения – аналогично)

Product for Registration Purposes Only

5F **Select Catheter**



Coloring Number	PNS5F130SIM
Lot Number	F90655



2023-08-20




Perseus Publishing  SP Select Collections

REF F960P1308AM 147 F96005

Partnership • EF Global Capital

REP PNEB1300M LOT P00005

Members of the Board of Directors

STYLISH	Stylish automatic pencil 文雅（自动）圆珠笔	Be Only
	No pens 不准带笔	NO
	No cell/mobile 禁止带手机	
	No cameras. No cell phone 禁止带照相机、移动电话等	
	No watches with external calculator 不准带手表、计算器	
	Calculators are prohibited for this 考试。禁止带计算器。	


Manufacturer:
Herscoville, Inc.
One Phoenix Place
Agawam, MA 01002, USA
Tel: 1-800-371-4039
Fax: 1-508-746-3030
E-mail: info@hsc.com

CE 2000

Local Representative:
Herscoville Europe GmbH
Am Rindwisch 44
D-33097 Bielefeld, Germany
Herscoville Norway Gustavite Bygging
Svein & Løvdal 1, 1-Løvdal, 2000
N-2007 Skjerve, Norway
Tel: 0047 6340 4040
Fax: 0047 6340 4041
E-mail: info@hsc.no

46. *Journal of the American Medical Association* 1916.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

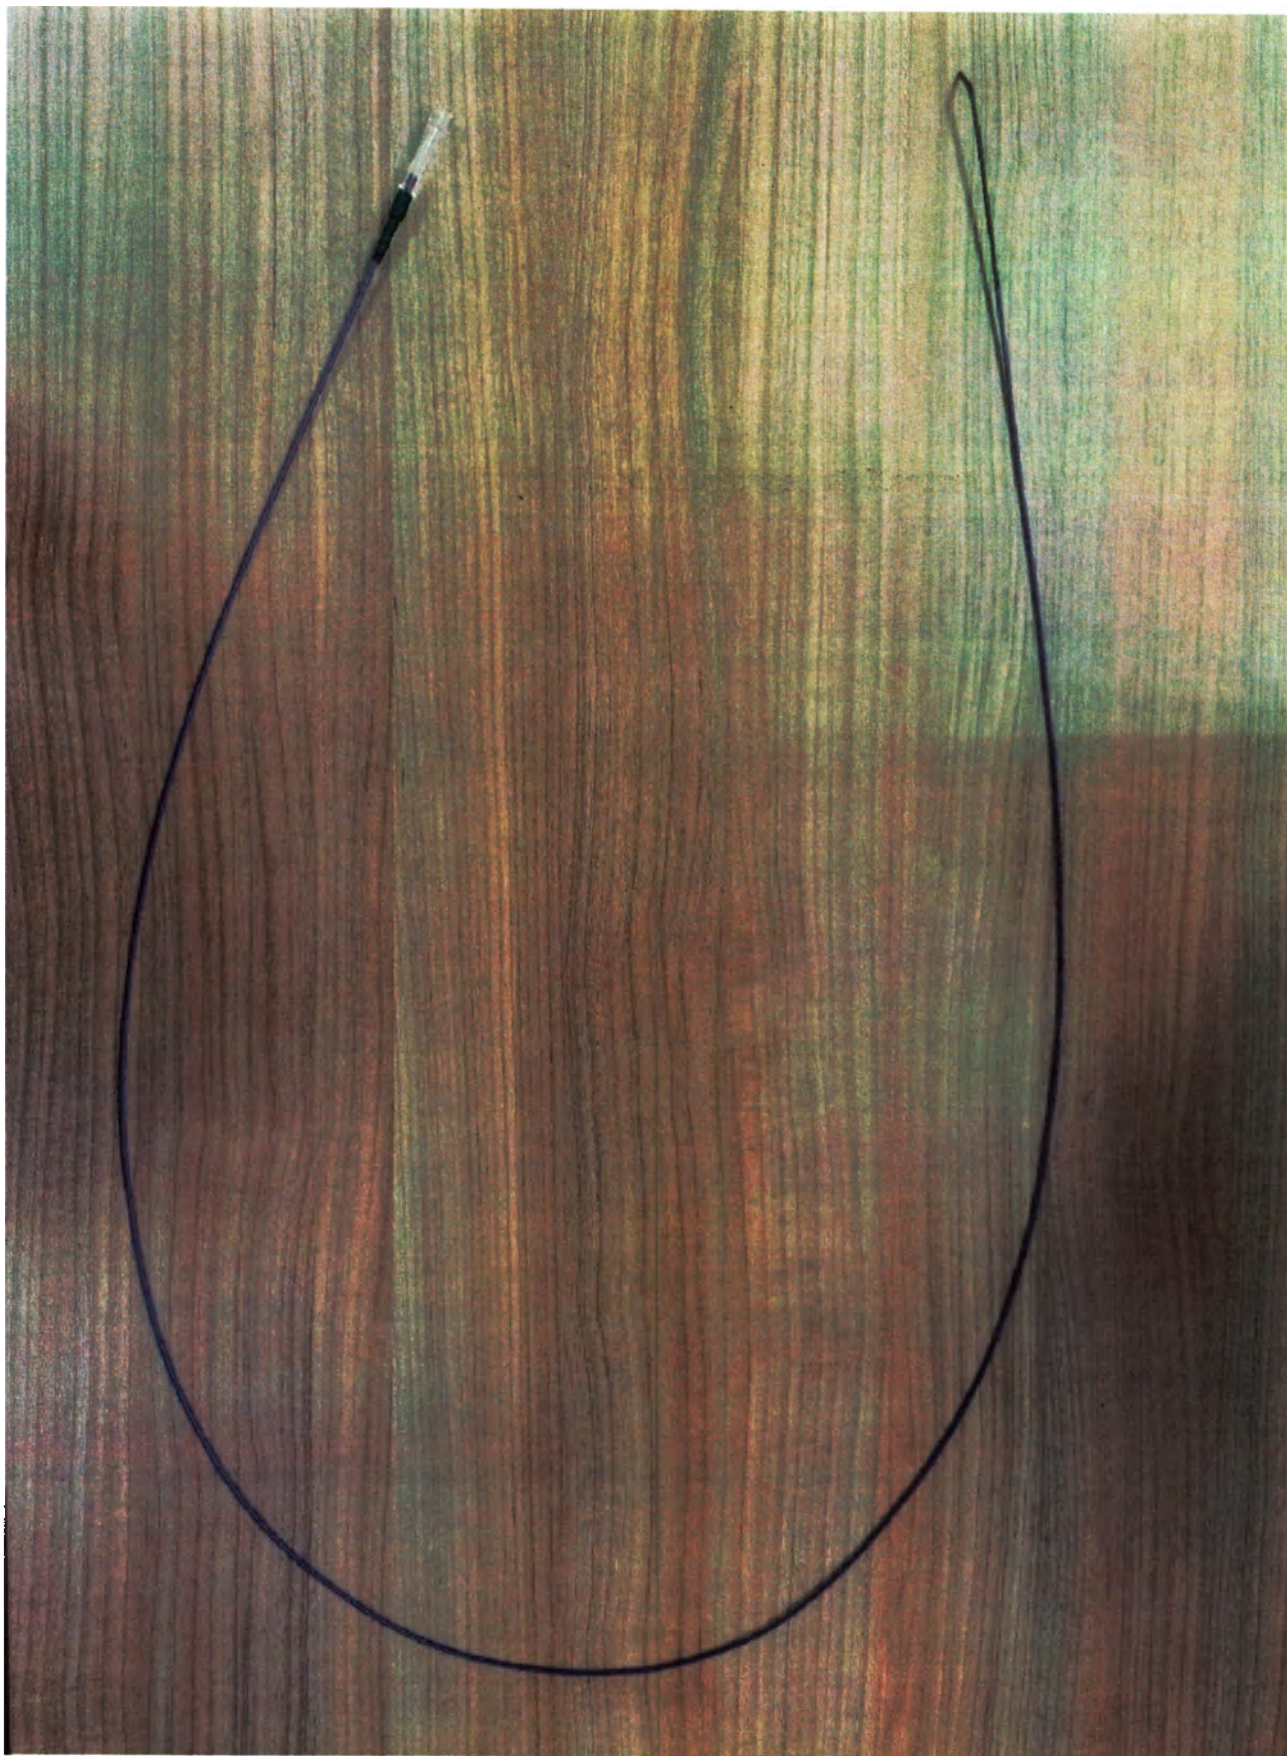

Катетер доставки Benchmark PNS5F120BER (для других вариантов исполнения – аналогично)




Катетер доставки Benchmark PNS5F120SIM (для других вариантов исполнения – аналогично)

Penumbra 
BENCHMARK

6F 071

Delivery Catheter

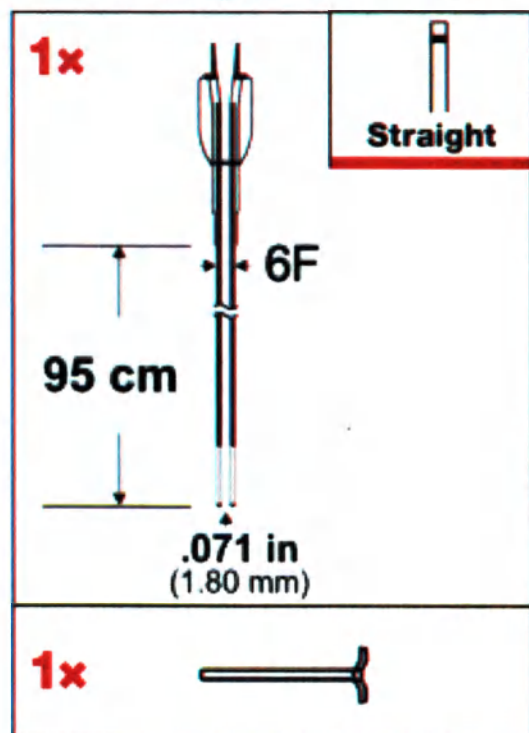

REF Catalog Number **BMK6F95**
型号

LOT Lot Number **F12345**
批号



Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95 **LOT** F12345



Penumbra  6F Benchmark 071

REF BMK6F95 **LOT** F12345



Penumbra  6F Benchmark 071

REF BMK6F95 **LOT** F12345



Penumbra  6F Benchmark 071

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原

MD



Do not resterilize
切勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。请勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see instructions for use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

制造商

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300.817.025
Fax: 1300.817.026
Email: order.auz@penumbrainc.com




Pat. www.penumbrainc.com/patents 7190.F

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: BMK6F95

Penumbra 
BENCHMARK™

6F 071
Delivery Catheter

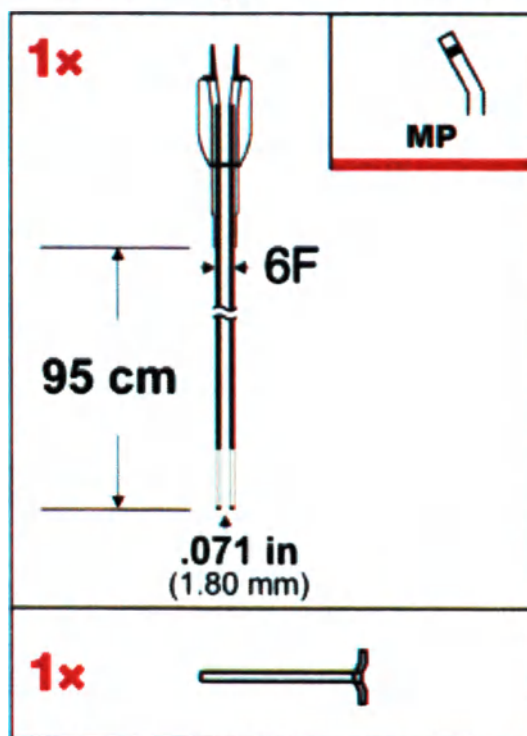

REF Catalog Number **BMK6F95M**
型号

LOT Lot Number **F12345**
批号



Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95M **LOT** F12345



Penumbra  6F Benchmark 071 MP

REF BMK6F95M **LOT** F12345



Penumbra  6F Benchmark 071 MP

REF BMK6F95M **LOT** F12345



Penumbra  6F Benchmark 071 MP

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only

 Nonpyrogenic
无热原

MD

 Do not resterilize
切勿重新灭菌

 Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。

 Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶

 Attention, see Instructions for Use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.auz@penumbrainc.com




Pat. www.penumbrainc.com/patents 7196.F

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: BMK6F95M

Penumbra 
BENCHMARK™

6F 071

Delivery Catheter

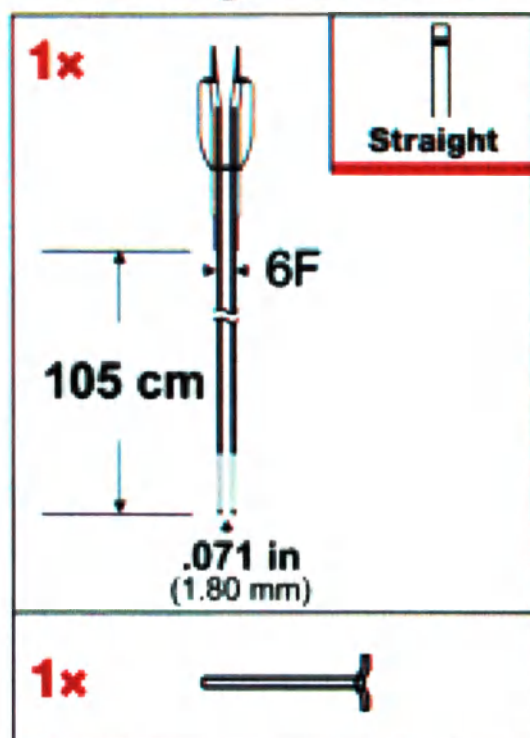

REF Catalog Number **BMK6F105**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014012(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F105 **LOT** F12345



(01)00814548014012(17)030531(10)F12345

Penumbra  **6F Benchmark 071**

REF BMK6F105 **LOT** F12345



(01)00814548014012(17)030531(10)F12345

Penumbra  **6F Benchmark 071**

REF BMK6F105 **LOT** F12345



(01)00814548014012(17)030531(10)F12345

Penumbra  **6F Benchmark 071**

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原

MD



Do not reheat
请勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用，请勿重复使用。



Not made with natural rubber latex.
不含天然乳胶。



Attention, see instructions for use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1 888 272-0000
Fax: 1 510 748-3200

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsgraben 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1000 817 025
Fax: 1000 817 026
Email: order.aus@penumbrainc.com




Pat. www.penumbrainc.com/patents 7203.F

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: BMK6F105

Penumbra 
BENCHMARK

6F 071
Delivery Catheter

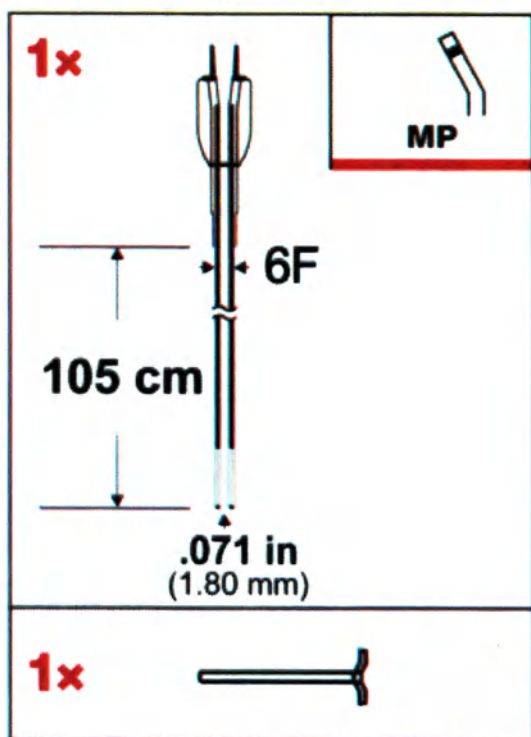

REF Catalog Number **BMK6F105M**

LOT Lot Number **F12345**



Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F105M **LOT** F12345



Penumbra  6F Benchmark 071 MP

REF BMK6F105M **LOT** F12345



Penumbra  6F Benchmark 071 MP

REF BMK6F105M **LOT** F12345



Penumbra  6F Benchmark 071 MP

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only

 Nonpyrogenic
无热原

MD

 Do not resterilize
切勿重新灭菌

 Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。

 Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶

 Attention, see instructions for Use.
注意。请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.auz@penumbrainc.com




Pat. www.penumbrainc.com/patents 7207.F

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: BMK6F105M

Penumbra 
BENCHMARK™

6F 071

Delivery Catheter

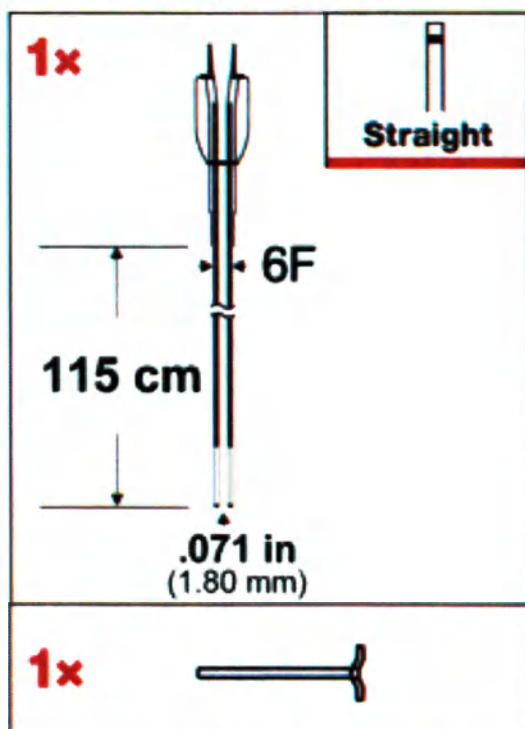

REF Catalog Number BMK6F115
型号

LOT Lot Number F12345
批号



Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F115 LOT F12345



Penumbra  6F Benchmark 071

REF BMK6F115 LOT F12345



Penumbra  6F Benchmark 071

REF BMK6F115 LOT F12345



Penumbra  6F Benchmark 071

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原

MD



Do not resterilize
请勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。请勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see instructions for use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.auz@penumbrainc.com




Pat. www.penumbrainc.com/patents 7211.F

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: BMK6F115

Penumbra 
BENCHMARK™

6F 071

Delivery Catheter

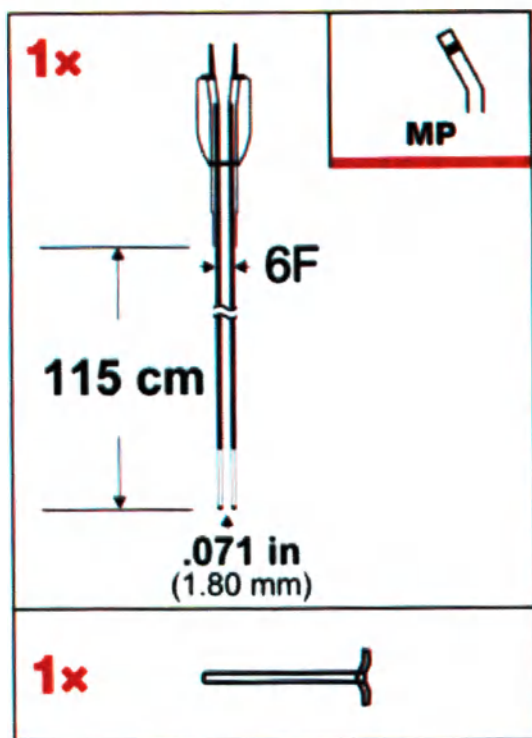

REF Catalog Number **BMK6F115M**
型号

LOT Lot Number **F12345**
批号



(01)00814548014104(17)030531(10)F12345

 Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F115M **LOT** F12345



(01)00814548014104(17)030531(10)F12345

Penumbra  **6F Benchmark 071 MP**

REF BMK6F115M **LOT** F12345



(01)00814548014104(17)030531(10)F12345

Penumbra  **6F Benchmark 071 MP**

REF BMK6F115M **LOT** F12345



(01)00814548014104(17)030531(10)F12345

Penumbra  **6F Benchmark 071 MP**

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原

MD



Do not resterilize
切勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see instructions for Use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.auz@penumbrainc.com



0050

Pat. www.penumbrainc.com/patents 7212.F

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: BMK6F115M


Penumbra BENCHMARK™

6F 071



Delivery Catheter

Use By: 使用截止日期
2003-05-31

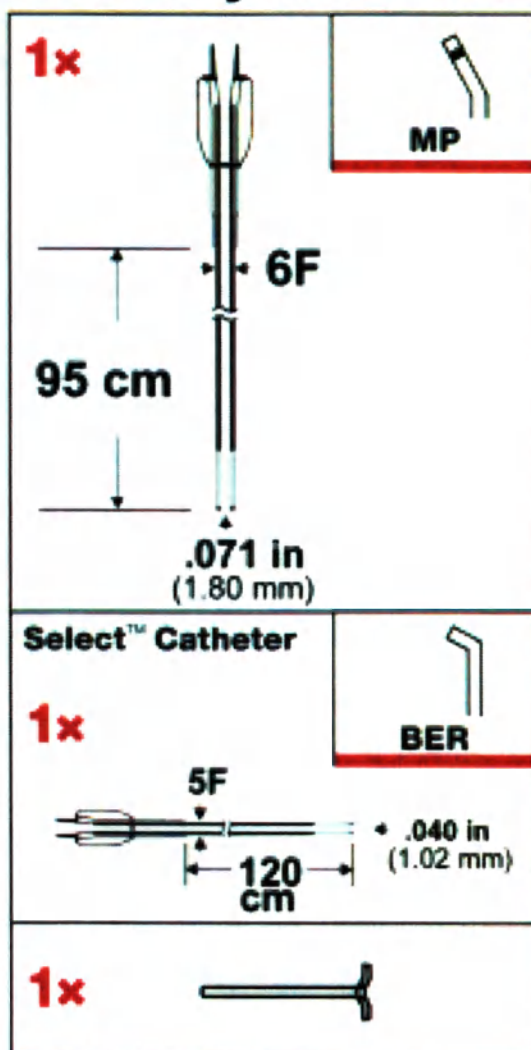

REF Catalog Number BMK6F95MBER120
型号

LOT Lot Number F12345
批号



(01)00814548014173(17)030531(10)F12345

REF BMK6F95MBER120 LOT F12345



(01)00814548014173(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

REF BMK6F95MBER120 LOT F12345



(01)00814548014173(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

REF BMK6F95MBER120 LOT F12345



(01)00814548014173(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原



Do not resterilize
切勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see instructions for use.
注意。请参阅使用说明。



制造商

Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4806
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.au@penumbrainc.com



Pat. www.penumbrainc.com/patents


7197.E

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95BER120


Penumbra BENCHMARK™

6F

071



Delivery Catheter

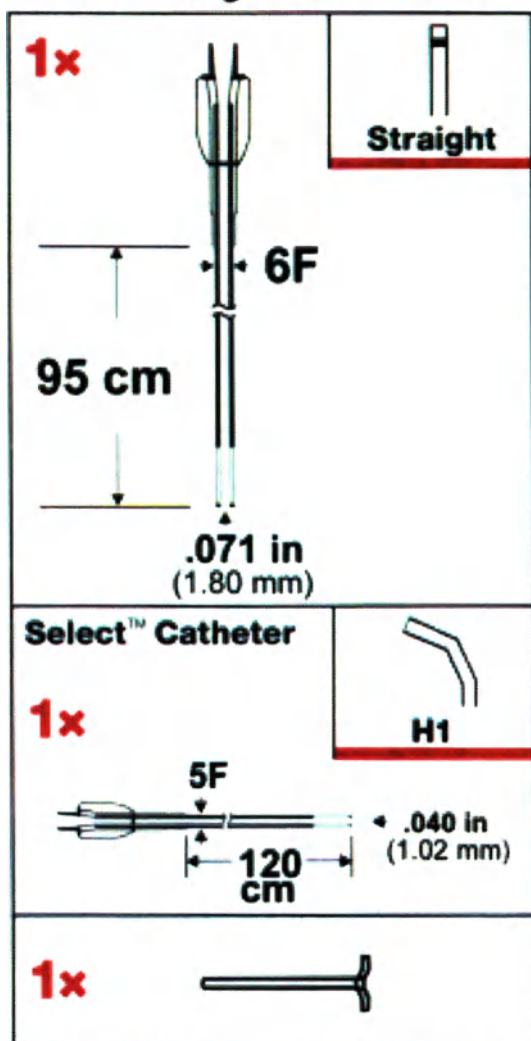

REF Catalog Number **BMK6F95H1120**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014142(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95H1120 **LOT** F12345



(01)00814548014142(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + H1 Select

REF BMK6F95H1120 **LOT** F12345



(01)00814548014142(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + H1 Select

REF BMK6F95H1120 **LOT** F12345



(01)00814548014142(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + H1 Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原

MD



Do not re-sterilize
切勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see instructions for use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC/REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturn 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.auz@penumbrainc.com



Pat. www.penumbrainc.com/patents 7191.E


Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95H1120

Penumbra **BENCHMARK**

6F 071

STR + SIM

Delivery Catheter

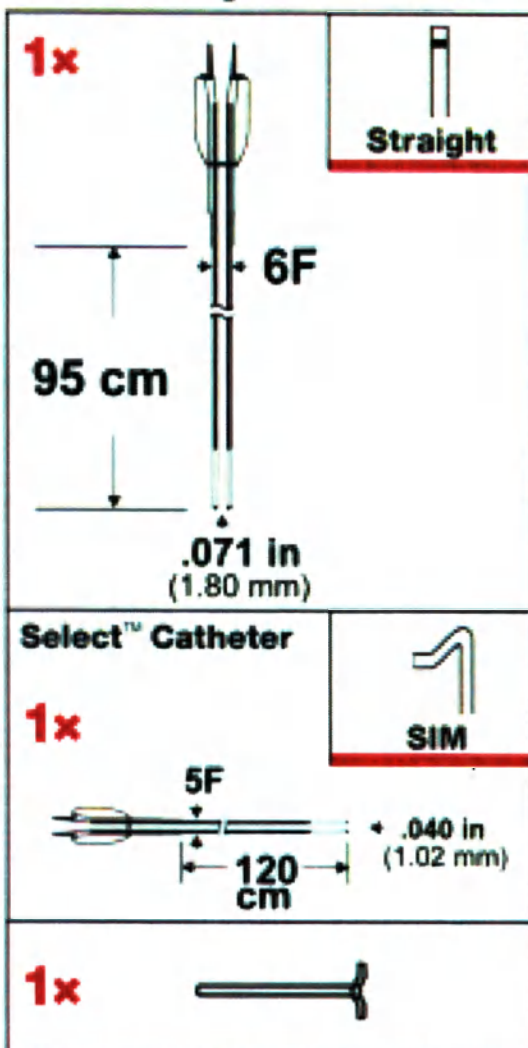

REF Catalog Number **BMK6F95SIM120**

LOT Lot Number **F12345**



10100814548014234(17)030531(10)F12345

Use By: 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95SIM120 **LOT** F12345



10100814548014234(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + SIM Select

REF BMK6F95SIM120 **LOT** F12345



10100814548014234(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + SIM Select

REF BMK6F95SIM120 **LOT** F12345



10100814548014234(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + SIM Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide) **Rx Only**



灭菌 (环氧乙烷)



Nonpyrogenic
无热原



Do not reenter
切勿重复使用



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。请勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see Instructions for Use.
注意：请参阅使用说明。




Manufacturer:

Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4806
1.510.768.3200
Fax: 1.510.768.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigpark 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Daringhurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 025
Email: order.aus@penumbra.com



Pat. www.penumbra.com/patents 7192 E


Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95SIM120

Penumbra BENCHMARK™

6F 071

STR + BER

Delivery Catheter

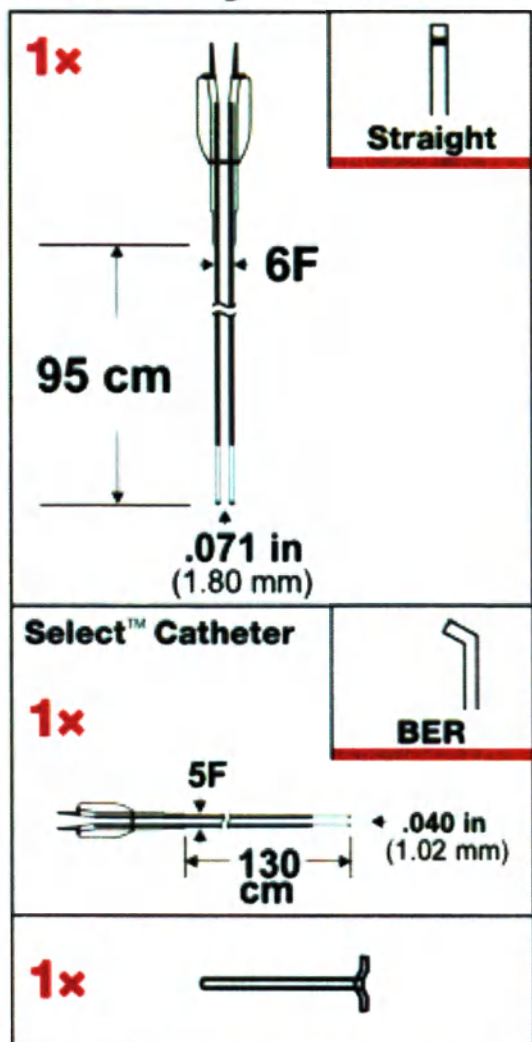

REF Catalog Number BMK6F95BER130

LOT Lot Number F12345



(01)00814548014135(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95BER130 LOT F12345



(01)00814548014135(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + BER Select

REF BMK6F95BER130 LOT F12345



(01)00814548014135(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + BER Select

REF BMK6F95BER130 LOT F12345



(01)00814548014135(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + BER Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)

灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only

Nonpyrogenic
无热原

Do not resterilize
切勿重新灭菌

Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。

Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶

Attention, see instructions for use.
注意，请参阅使用说明。



制造商

Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1 888 272 4606
1 510 748 3200
Fax: 1 510 748 3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.anz@penumbrainc.com




0050

Pat. www.penumbrainc.com/patents 7193.E


Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95BER130

Penumbra **BENCHMARK**

6F 071



Delivery Catheter

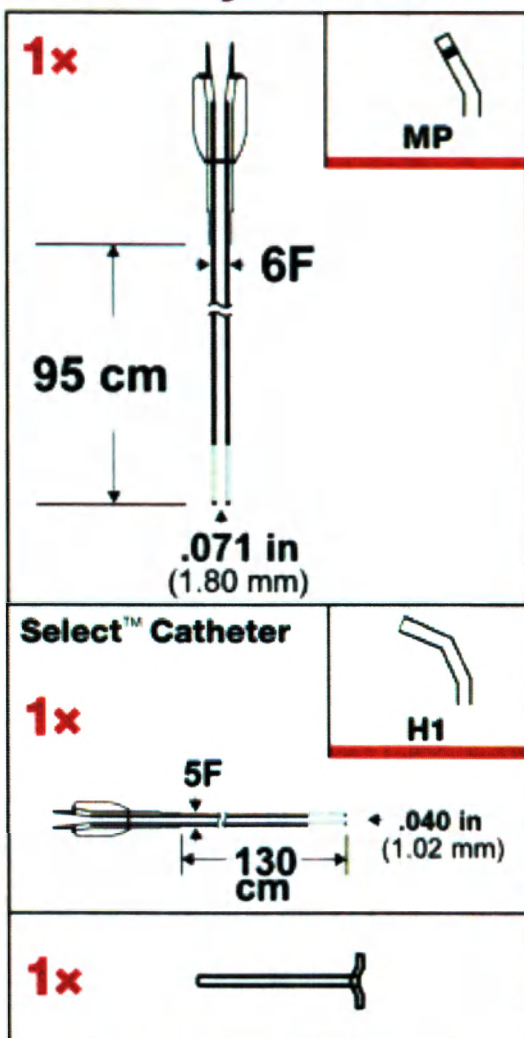

REF Catalog Number **BMK6F95MH1130**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014203(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95MH1130 **LOT** F12345



(01)00814548014203(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

REF BMK6F95MH1130 **LOT** F12345



(01)00814548014203(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

REF BMK6F95MH1130 **LOT** F12345



(01)00814548014203(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原



Do not resterilize
切勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see instructions for use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.anz@penumbrainc.com



Pat. www.penumbrainc.com/patents 7201.E

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95H1130


Penumbra **BENCHMARK**

6F

071

MP + SIM

Delivery Catheter

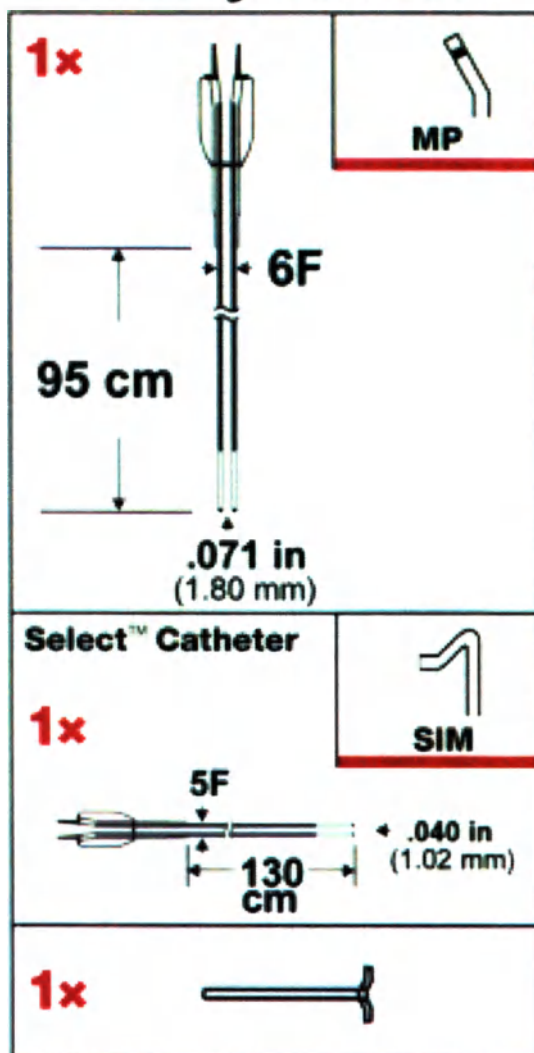

REF Catalog Number **BMK6F95MSIM130**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014227(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95MSIM130 LOT F12345



(01)00814548014227(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

REF BMK6F95MSIM130 LOT F12345



(01)00814548014227(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

REF BMK6F95MSIM130 LOT F12345



(01)00814548014227(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only

 Nonpyrogenic
无热原

MD

 Do not resterilize
切勿重新灭菌

 Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。

 Not made with natural rubber latex.
不含天然乳胶。

 Attention, see Instructions for Use.
注意：请参阅使用说明。

Manufacturer
制造商

Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4806
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 025
Email: order.au@penumbrainc.com

CE (05)

Pat. www.penumbrainc.com/patents 7202.E

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95SIM130


Penumbra **BENCHMARK**

6F

071

MP + BER

Delivery Catheter

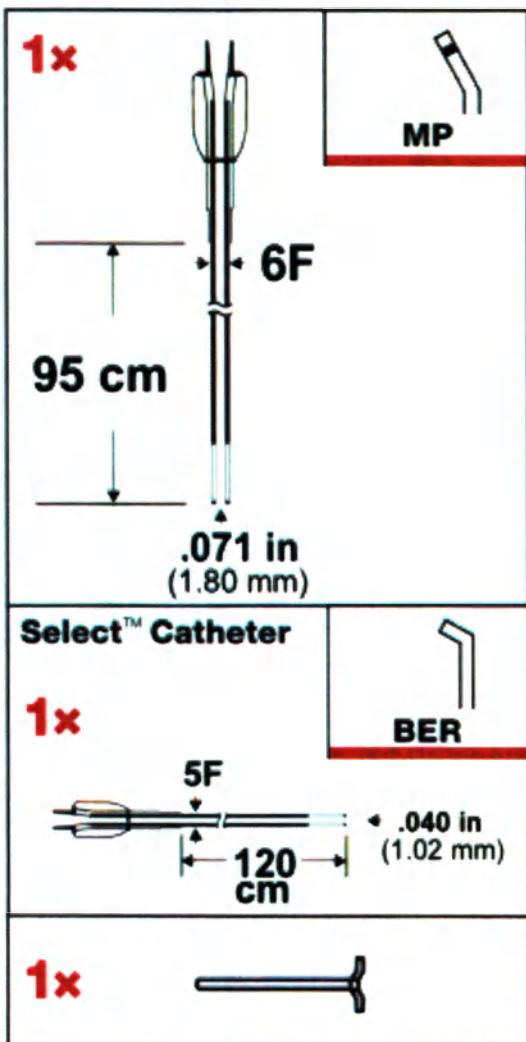

REF Catalog Number **BMK6F95MBER120**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014173(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95MBER120 **LOT** F12345



(01)00814548014173(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

REF BMK6F95MBER120 **LOT** F12345



(01)00814548014173(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

REF BMK6F95MBER120 **LOT** F12345



(01)00814548014173(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原

MD



Do not resterilize
切勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see instructions for use.
注意：请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.anz@penumbrainc.com




Pat. www.penumbrainc.com/patents 7197.E

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MBER120


Penumbra BENCHMARK™

6F

071



Delivery Catheter

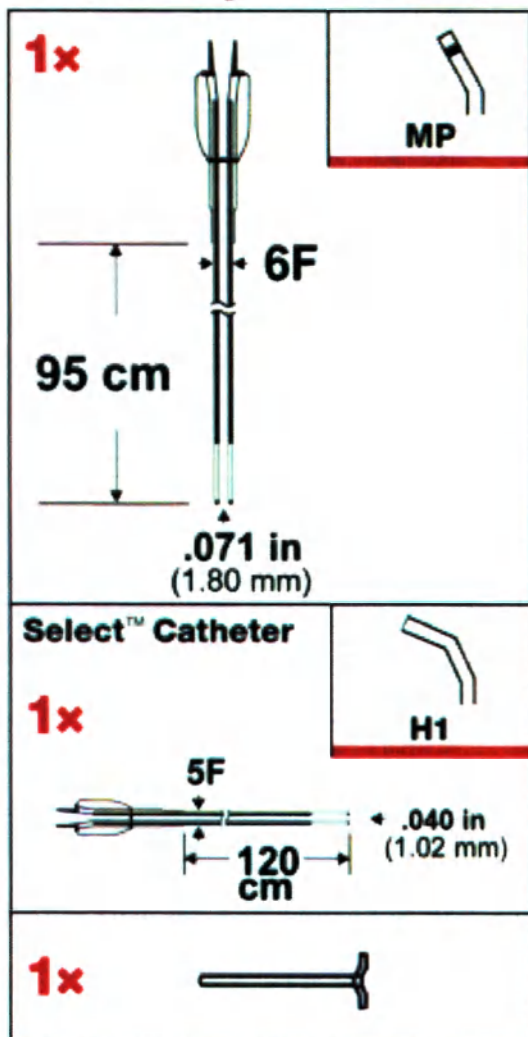

REF Catalog Number 型号 **BMK6F95MH1120**

LOT Lot Number 批号 **F12345**



(01)00814548014197(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95MH1120 **LOT** F12345



(01)00814548014197(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

REF BMK6F95MH1120 **LOT** F12345



(01)00814548014197(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

REF BMK6F95MH1120 **LOT** F12345



(01)00814548014197(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only

 Nonpyrogenic
无热原

MD

 Do not resterilize
切勿重新灭菌

 Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。

 Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶

 Attention, see Instructions for Use.
注意。请参阅使用说明。




Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.auz@penumbrainc.com



Pat. www.penumbrainc.com/patents 7198.E

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MH1120


Penumbra **BENCHMARK™**

6F

071

MP + SIM

Delivery Catheter

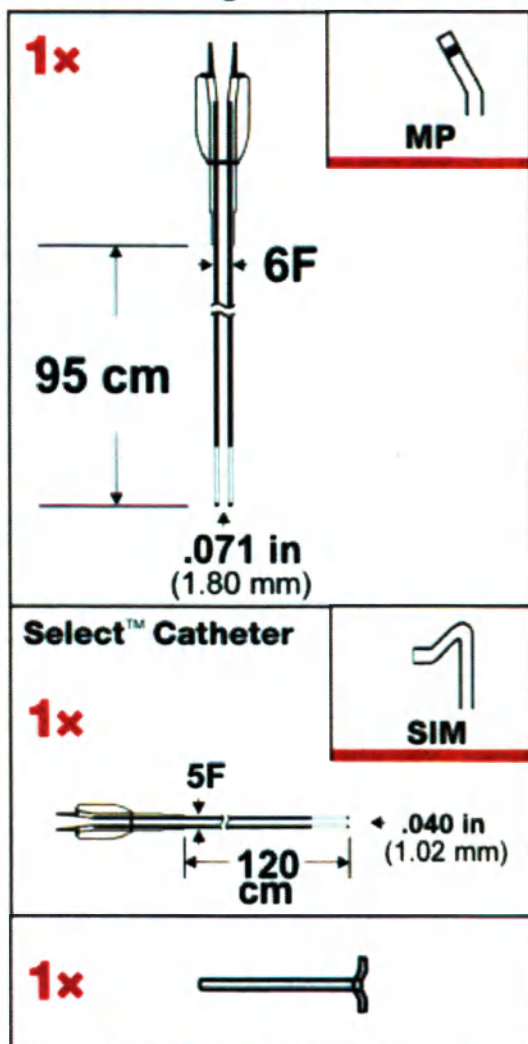

REF Catalog Number **BMK6F95MSIM120**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014210(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95MSIM120 **LOT** F12345



(01)00814548014210(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

REF BMK6F95MSIM120 **LOT** F12345



(01)00814548014210(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

REF BMK6F95MSIM120 **LOT** F12345



(01)00814548014210(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原



Do not resterilize
切勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see instructions for use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.anz@penumbrainc.com



Pat. www.penumbrainc.com/patents 7199.E

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MSIM120


Penumbra **BENCHMARK**

6F

071



Delivery Catheter

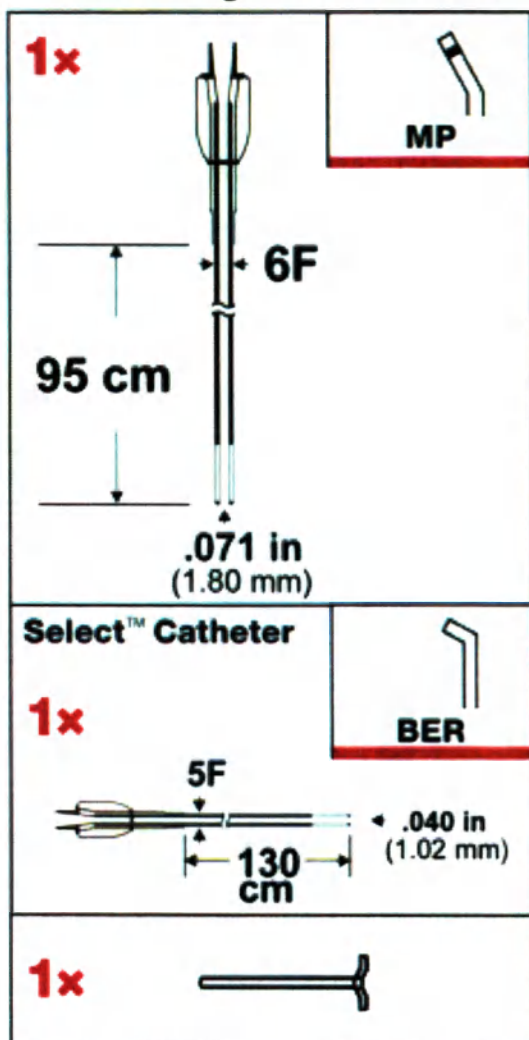

REF Catalog Number **BMK6F95MBER130**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014180(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95MBER130 **LOT** F12345



(01)00814548014180(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

REF BMK6F95MBER130 **LOT** F12345



(01)00814548014180(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

REF BMK6F95MBER130 **LOT** F12345



(01)00814548014180(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

STERILE **EO** Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only

 Nonpyrogenic
无热原

MD

 Do not resterilize
切勿重新灭菌

 Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。

 Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶

 Attention, see Instructions for Use.
注意。请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 028
Email: order.auz@penumbrainc.com




Pat. www.penumbrainc.com/patents 7200.E


Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MBER130

Penumbra **BENCHMARK**

6F 071



Delivery Catheter

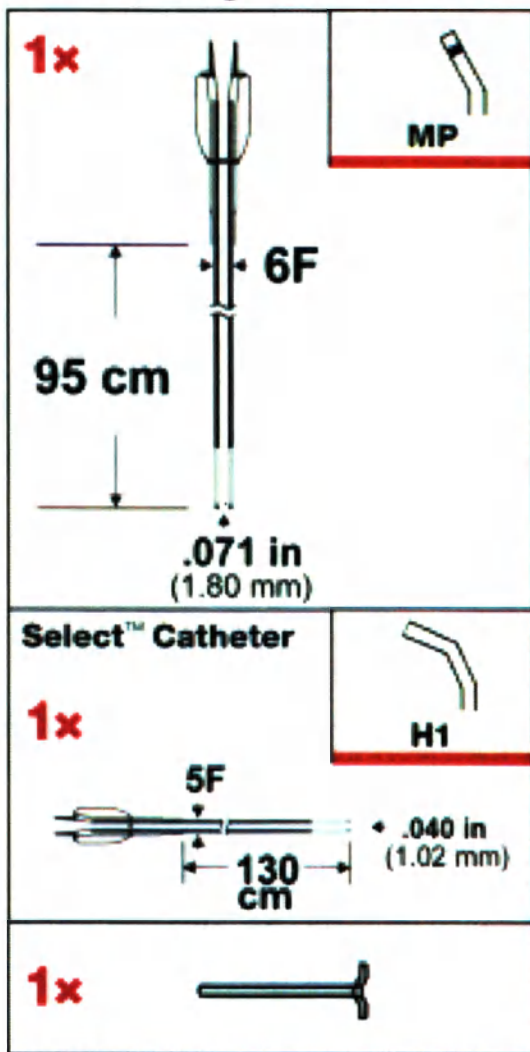

REF Catalog Number **BMK6F95MH1130**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014203(17)030531(10)F12345

Use By / 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95MH1130 **LOT** F12345



(01)00814548014203(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

REF BMK6F95MH1130 **LOT** F12345



(01)00814548014203(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

REF BMK6F95MH1130 **LOT** F12345



(01)00814548014203(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原



Do not resterilize
请勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see instructions for use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Bornsturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.au@penumbra.com




Pat. www.penumbra.com/patents 7201.E

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MH1130


Penumbra **BENCHMARK**

6F

071



Delivery Catheter

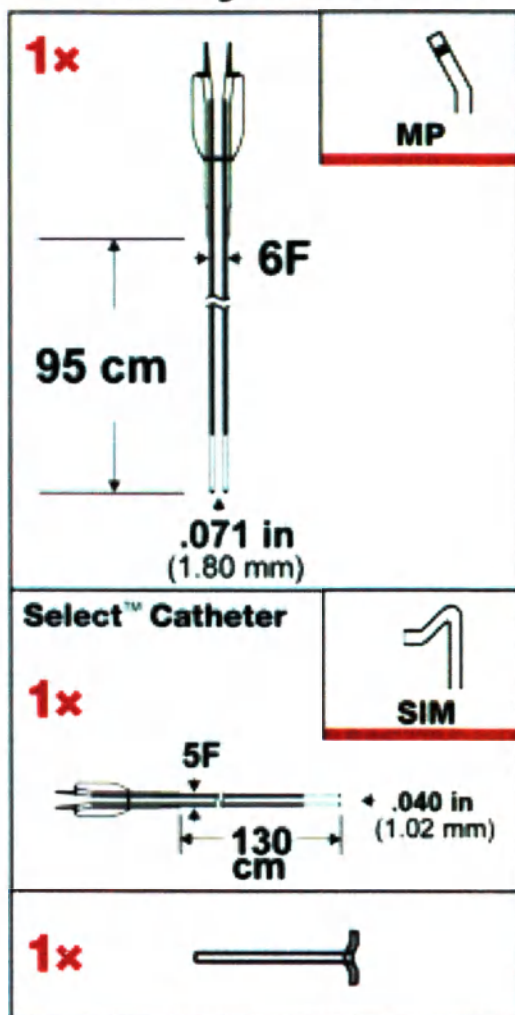

REF Catalog Number **BMK6F95MSIM130**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014227(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F95MSIM130 **LOT** F12345



(01)00814548014227(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

REF BMK6F95MSIM130 **LOT** F12345



(01)00814548014227(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

REF BMK6F95MSIM130 **LOT** F12345



(01)00814548014227(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only

 Nonpyrogenic
无热原

MD

 Do not resterilize
切勿重新灭菌

 Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。

 Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶

 Attention, see Instructions for Use.
注意，请参阅使用说明。



制造商

Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4806
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 025
Email: order.auz@penumbrainc.com



Pat. www.penumbrainc.com/patents 7202.E

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MSIM130


Penumbra BENCHMARK™

6F

071

STR + BER

Delivery Catheter

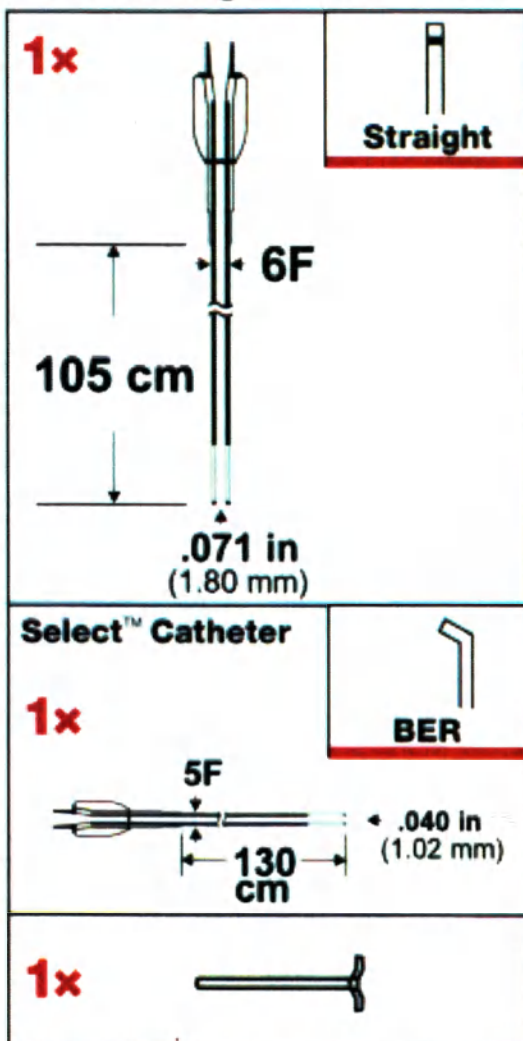

REF Catalog Number BMK6F105BER130

LOT Lot Number F12345



(01)00814548014029(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F105BER130 LOT F12345



(01)00814548014029(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + BER Select

REF BMK6F105BER130 LOT F12345



(01)00814548014029(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + BER Select

REF BMK6F105BER130 LOT F12345



(01)00814548014029(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + BER Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原



Do not resterilize
切勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see instructions for use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.auz@penumbrainc.com



Pat. www.penumbrainc.com/patents 7204.E


Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105BER130

Penumbra **BENCHMARK**™

6F 071

STR + H1

Delivery Catheter

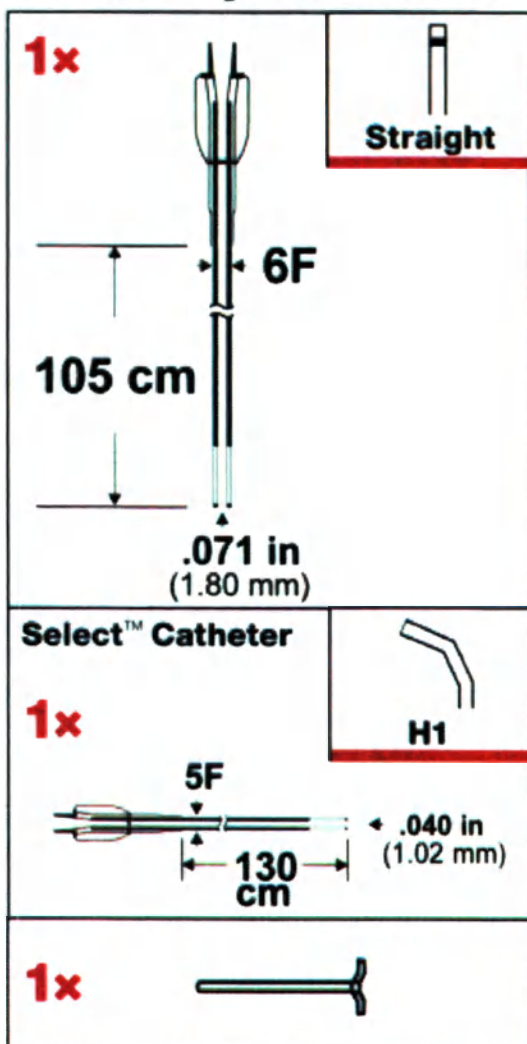

REF Catalog Number **BMK6F105H1130**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014036(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F105H1130 **LOT** F12345



(01)00814548014036(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + H1 Select

REF BMK6F105H1130 **LOT** F12345



(01)00814548014036(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + H1 Select

REF BMK6F105H1130 **LOT** F12345



(01)00814548014036(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + H1 Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only

 Nonpyrogenic
无热原

MD

 Do not resterilize
切勿重新灭菌

 Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。

 Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶

 Attention, see instructions for Use.
注意：请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC/REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.anz@penumbrainc.com



Pat. www.penumbrainc.com/patents 7205.E


Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105H1130

Penumbra **BENCHMARK**

6F 071

STR + SIM

Delivery Catheter

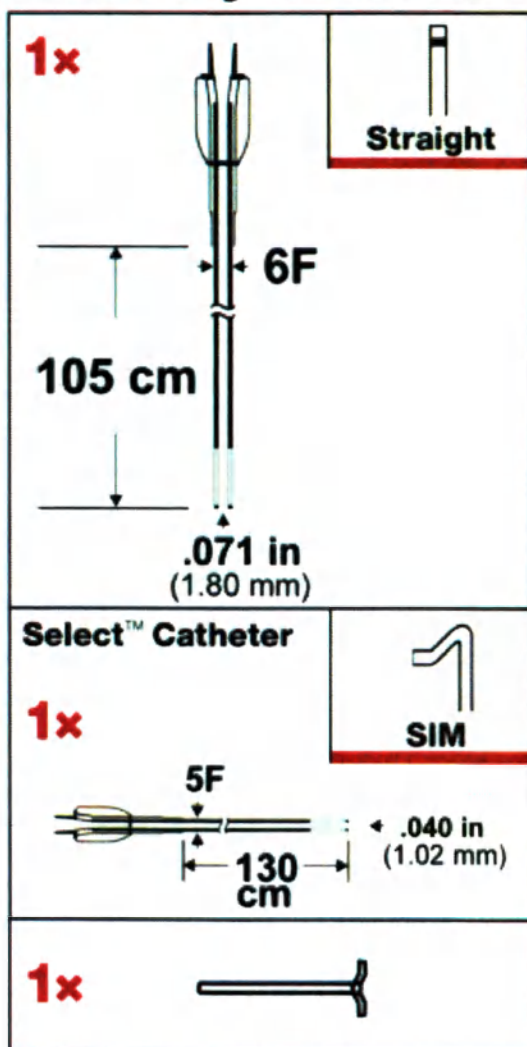

REF Catalog Number **BMK6F105SIM130**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014081(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F105SIM130 **LOT** F12345



(01)00814548014081(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + SIM Select

REF BMK6F105SIM130 **LOT** F12345



(01)00814548014081(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + SIM Select

REF BMK6F105SIM130 **LOT** F12345



(01)00814548014081(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 + SIM Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only

 Nonpyrogenic
无热原

MD

 Do not resterilize
切勿重新灭菌

 Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。

 Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶

 Attention, see Instructions for Use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.anz@penumbrainc.com



Pat. www.penumbrainc.com/patents 7206.E

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105SIM130


Penumbra **BENCHMARK**TM

6F

071

MP + BER

Delivery Catheter

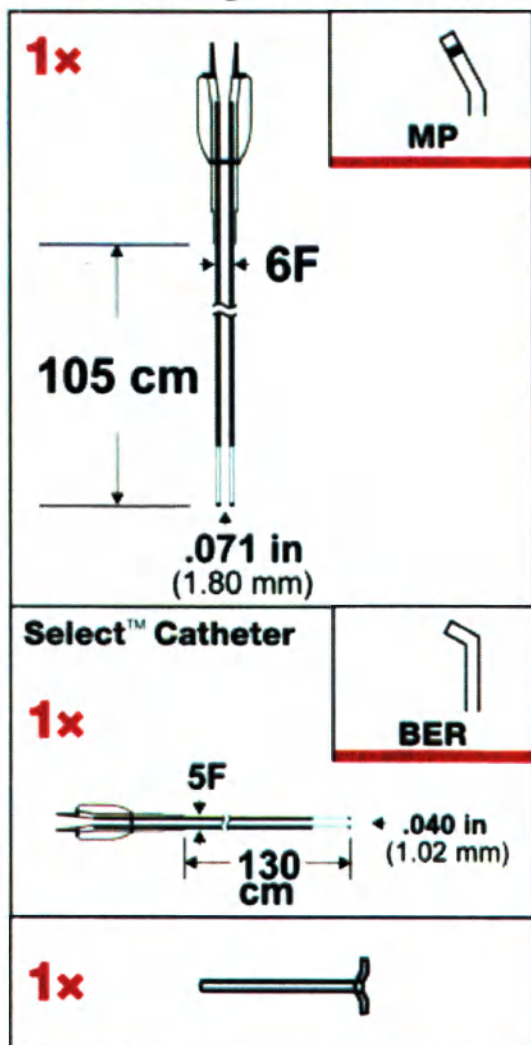

REF Catalog Number **BMK6F105MBER130**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014050(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F105MBER130 **LOT** F12345



(01)00814548014050(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

REF BMK6F105MBER130 **LOT** F12345



(01)00814548014050(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

REF BMK6F105MBER130 **LOT** F12345



(01)00814548014050(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + BER Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only



Nonpyrogenic
无热原



Do not resterilize
切勿重新灭菌



Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。



Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶



Attention, see instructions for Use.
注意，请参阅使用说明。



制造商

Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.anz@penumbrainc.com



0050

Pat. www.penumbrainc.com/patents 7208.E


Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105MBER130

Penumbra **BENCHMARK**TM

6F 071



Delivery Catheter

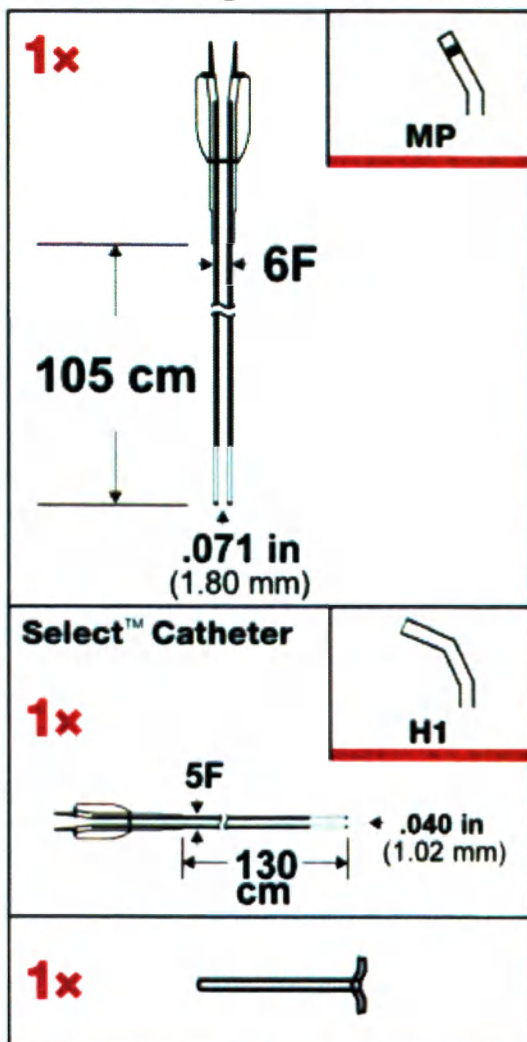

REF Catalog Number **BMK6F105MH1130**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014067(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F105MH1130 **LOT** F12345



(01)00814548014067(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

REF BMK6F105MH1130 **LOT** F12345



(01)00814548014067(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

REF BMK6F105MH1130 **LOT** F12345



(01)00814548014067(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + H1 Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only

 Nonpyrogenic
无热原

MD

 Do not resterilize
切勿重新灭菌

 Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。

 Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶

 Attention, see instructions for use.
注意，请参阅使用说明。



Manufacturer:

Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: orderanz@penumbrainc.com



Pat. www.penumbrainc.com/patents 7209.E


Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105MH1130

Penumbra **BENCHMARK**

6F 071

MP + SIM

Delivery Catheter

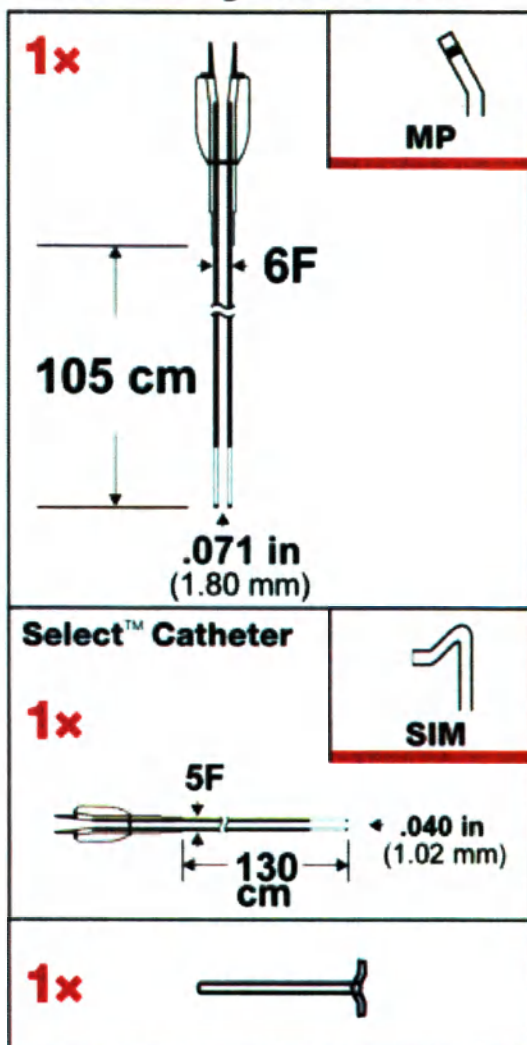

REF Catalog Number **BMK6F105MSIM130**

LOT Lot Number **F12345**



(01)00814548014074(17)030531(10)F12345

Use By 使用截止日期
2003-05-31

REF BMK6F105MSIM130 **LOT** F12345



(01)00814548014074(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

REF BMK6F105MSIM130 **LOT** F12345



(01)00814548014074(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

REF BMK6F105MSIM130 **LOT** F12345



(01)00814548014074(17)030531(10)F12345

Penumbra  6F Benchmark 071 MP + SIM Select

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)
灭菌 (环氧乙烷)

Rx Only

 Nonpyrogenic
无热原

MD

 Do not resterilize
切勿重新灭菌

 Single use only. Do not reuse.
仅供一次性使用。切勿重复使用。

 Not made with natural rubber latex
不含天然乳胶

 Attention, see Instructions for Use.
注意，请参阅使用说明。

 制造商

Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP 欧盟授权代表

EU Representative
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Penumbra Neuro Australia Pty Ltd
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010, Australia
Tel: 1300 817 025
Fax: 1300 817 026
Email: order.anz@penumbrainc.com

CE 0050

Pat. www.penumbrainc.com/patents 7210.E


Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105MSIM130

Penumbra 

Neuron™
Select™

5F

Select Catheter

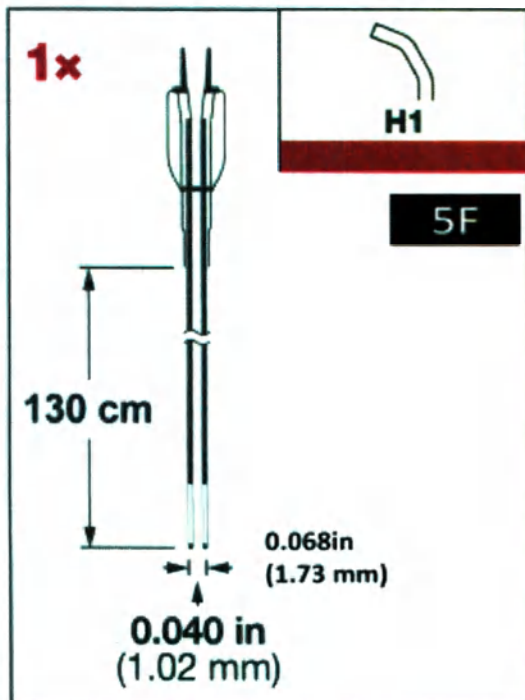

REF Catalog Number PNS5F130H1

LOT Lot Number F12345678



(01)00815948027879(17)030531(10)F12345678



Use By

2003-05-31

REF PNS5F130H1

LOT F12345678



(01)00815948027879(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F130H1

LOT F12345678



(01)00815948027879(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F130H1

LOT F12345678



(01)00815948027879(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)

Rx Only



Nonpyrogenic



Do not resterilize



Single use only. Do not reuse.



Not made with natural rubber latex



Attention, see instructions for Use.



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

EU Representative:
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany



0050

Pat. www.penumbrainc.com/patents

26871.A

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: PNS5F130H1


Penumbra 

Neuron™

Select™

5F

Select Catheter

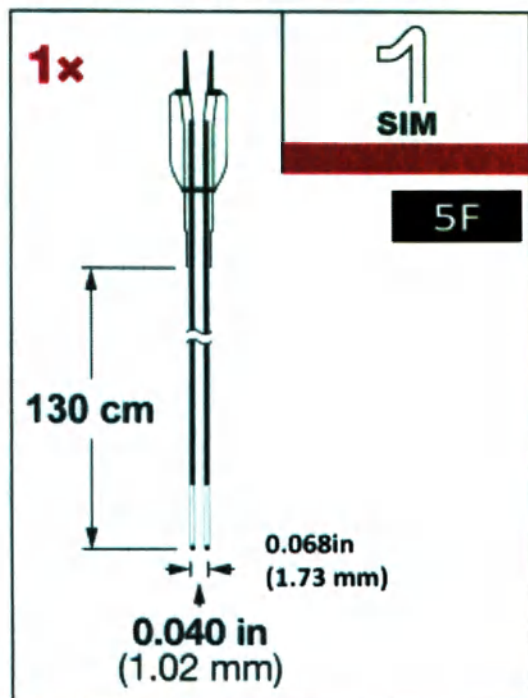

REF Catalog Number PNS5F130SIM

LOT Lot Number F12345678



(01)00815948027886(17)030531(10)F12345678

 Use By 2003-05-31

REF PNS5F130SIM **LOT** F12345678



(01)00815948027886(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F130SIM **LOT** F12345678



(01)00815948027886(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F130SIM **LOT** F12345678



(01)00815948027886(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)

Rx Only

 Nonpyrogenic

 Do not resterilize

 Single use only. Do not reuse.

 Not made with natural rubber latex

 Attention, see Instructions for Use.



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC/REP

EU Representative:
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany



0050

Pat. www.penumbrainc.com/patents

26872 A

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: PNS5F130SIM


Penumbra 

Neuron™

Select™

5F

Select Catheter

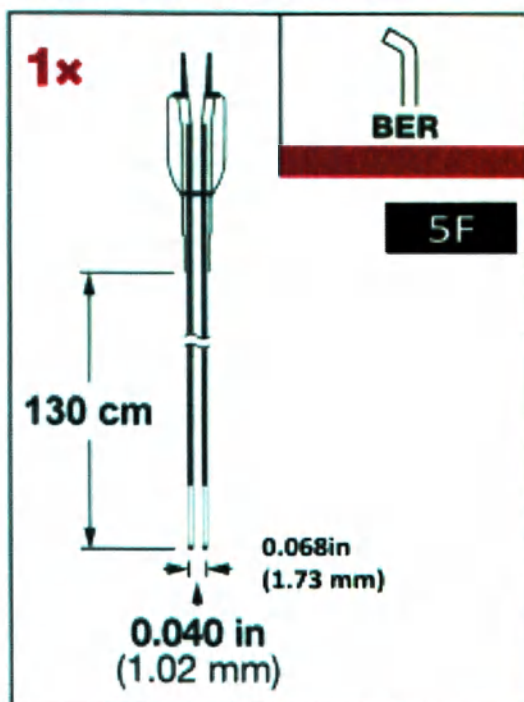

REF Catalog Number PNS5F130BER

LOT Lot Number F12345678



(01)00815948027893(17)030531(10)F12345678



Use By

2003-05-31

REF PNS5F130BER **LOT** F12345678



(01)00815948027893(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F130BER **LOT** F12345678



(01)00815948027893(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F130BER **LOT** F12345678



(01)00815948027893(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)

Rx Only



Nonpyrogenic



Do not resterilize



Single use only. Do not reuse.



Not made with natural rubber latex




Attention, see Instructions for Use.



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

EU Representative:
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany



0050

Pat. www.penumbrainc.com/patents

26873.A

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: PNS5F130BER


Penumbra 

Neuron™

Select™

5F

Select Catheter

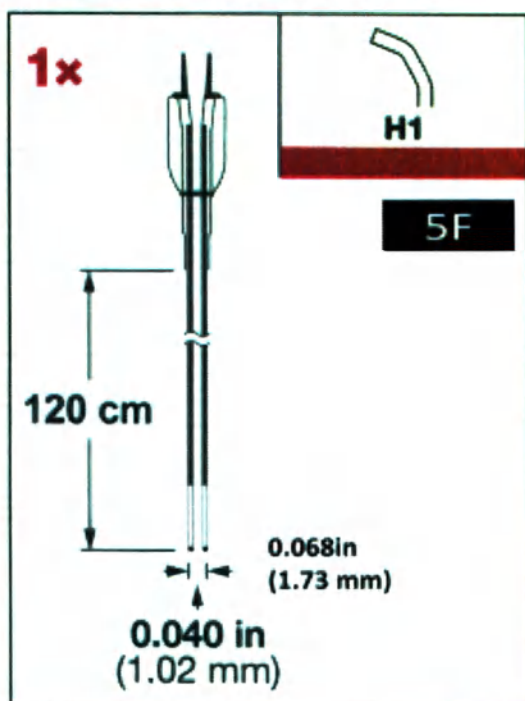

REF Catalog Number **PNS5F120H1**

LOT Lot Number **F12345678**



(01)00815948027909(17)030531(10)F12345678

 Use By **2003-05-31**

REF PNS5F120H1 **LOT** F12345678



(01)00815948027909(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F120H1 **LOT** F12345678



(01)00815948027909(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F120H1 **LOT** F12345678



(01)00815948027909(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)

Rx Only



Nonpyrogenic



Do not resterilize



Single use only. Do not reuse.



Not made with natural rubber latex



Attention, see Instructions for Use.



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

EU Representative:
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany



0050

Pat. www.penumbrainc.com/patents

26874.A

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: PNS5F120H1


Penumbra 

Neuron™

Select™

5F

Select Catheter

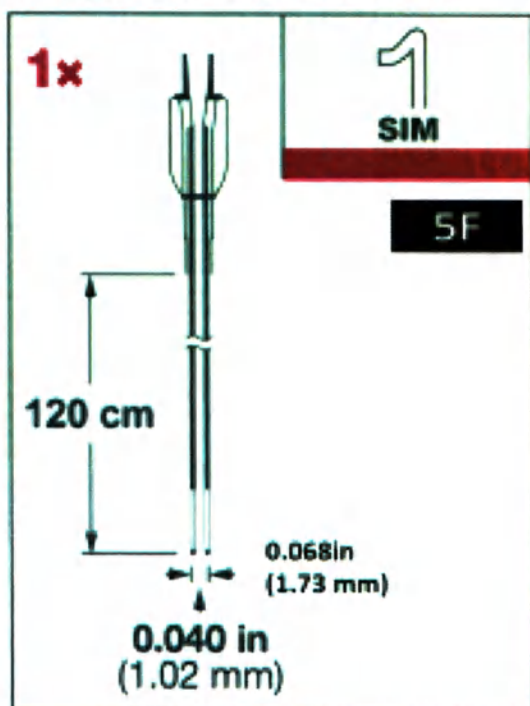

REF Catalog Number PNS5F120SIM

LOT Lot Number F12345678



(01)00815948027916(17)030531(10)F12345678

 Use by 2003-05-31

REF PNS5F120SIM **LOT** F12345678



(01)00815948027916(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F120SIM **LOT** F12345678



(01)00815948027916(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F120SIM **LOT** F12345678



(01)00815948027916(17)030531(10)F12345678

Penumbra  5F Select Catheter

STERILE EO Sterile ethylene oxide

Rx Only



Nonpyrogenic



Do not resterilize



Single use only. Do not reuse



Not made with natural rubber latex



Attention, see Instructions for Use



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

EU Representative:
Penumbra Europe GmbH
Am Bonnsturm 44
13567 Berlin, Germany



0050

For: www.penumbrainc.com/patents 26875_A

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: PNS5F120SIM


Penumbra 

Neuron™

Select™

5F

Select Catheter

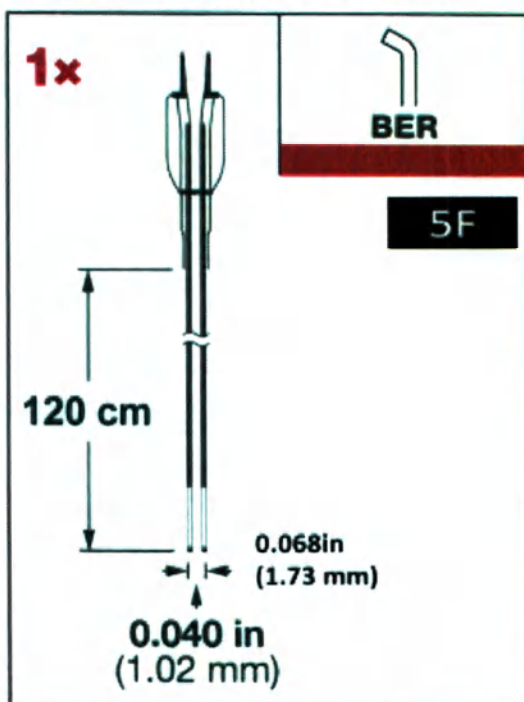

REF Catalog Number **PNS5F120BER**

LOT Lot Number **F12345678**



 Use By **2003-05-31**

REF PNS5F120BER **LOT** F12345678



Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F120BER **LOT** F12345678



Penumbra  5F Select Catheter

REF PNS5F120BER **LOT** F12345678



Penumbra  5F Select Catheter

STERILE EO Sterile (ethylene oxide)

Rx Only



Nonpyrogenic



Do not sterilize



Single use only. Do not reuse.



Not made with natural rubber latex.



Attention, see Instructions for Use.



Manufacturer:
Penumbra, Inc.
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

EU Representative:
Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany



Pat. www.penumbrainc.com/patents


26876.A

Оригинальная маркировка. Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: PNS5F120BER



Катетер доставки BENCHMARK

6F 071

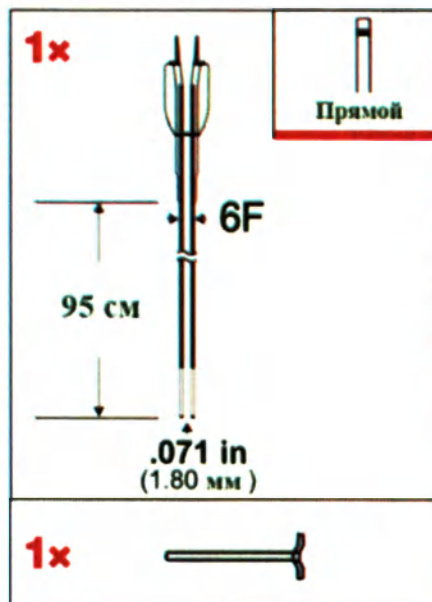

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

REF

BMK6F95

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: BMK6F95

Penumbra 

Катетер доставки BENCHMARK

6F 071

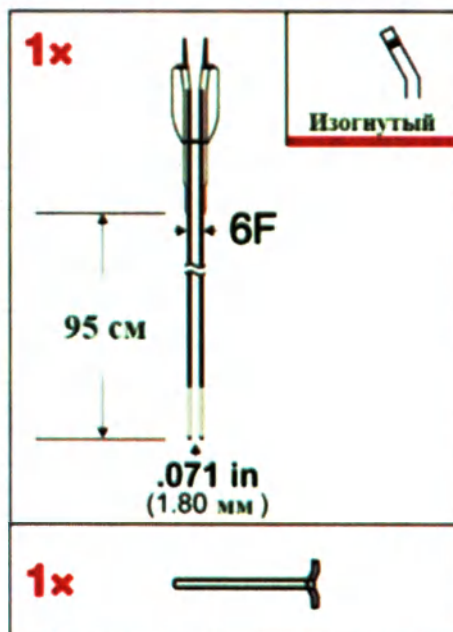

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

REF

BMK6F95M

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: BMK6F95M

Penumbra 

Катетер доставки BENCHMARK

6F 071

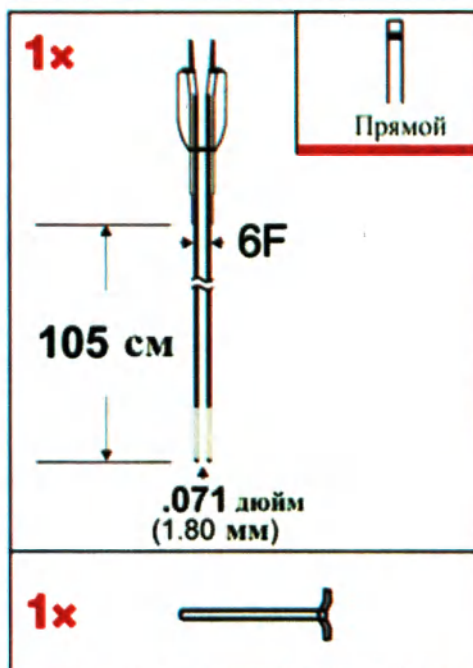

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F105

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: BMK6F105

Penumbra 

Катетер доставки BENCHMARK

6F 071

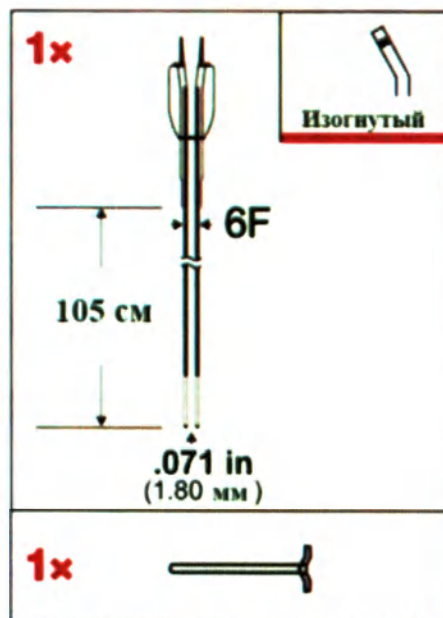

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F105M

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

ПУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105M

Penumbra 

Катетер доставки BENCHMARK

6F 071

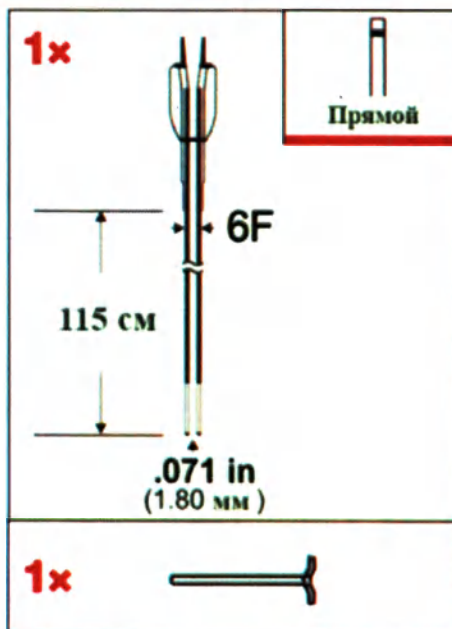

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F115

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: BMK6F115

Penumbra 

Катетер доставки BENCHMARK

6F 071

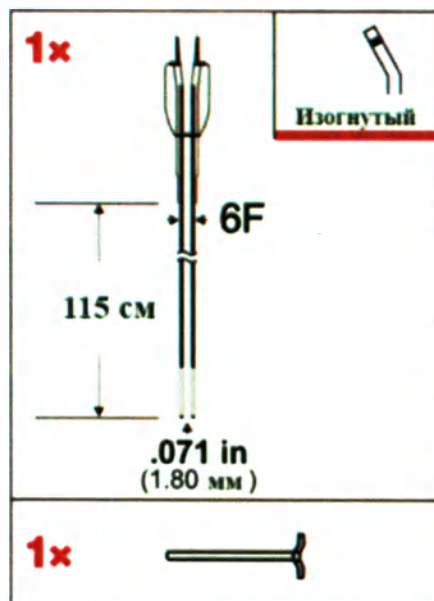

STERILE EO Rx Only MD

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F115M

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

ПУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

**Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F115M**



Катетер доставки BENCHMARK

6F 071 Прямой + BER

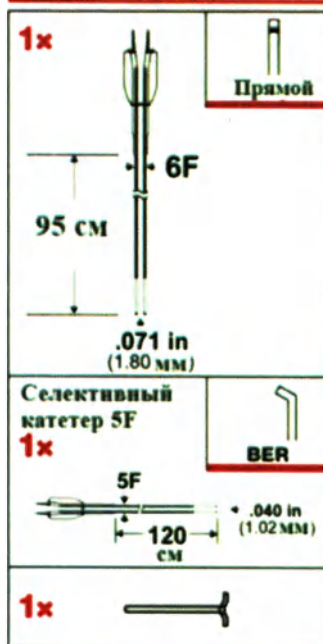

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F95BER120

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768


РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95BER120



Катетер доставки BENCHMARK

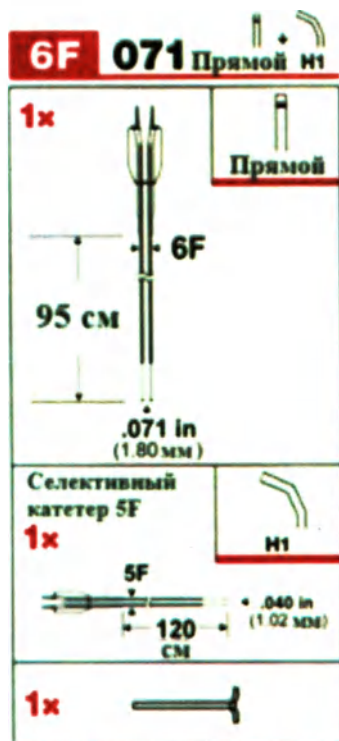

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F95H1120

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768


РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95H1120



Катетер доставки BENCHMARK

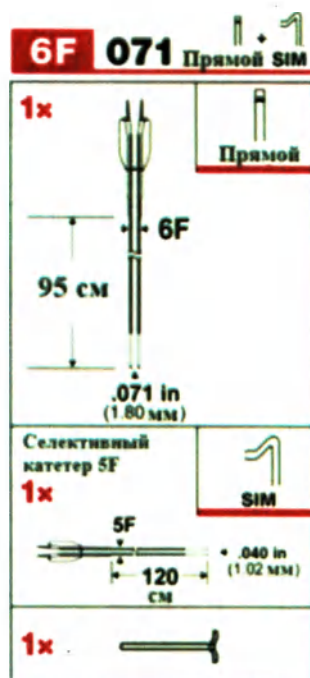

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F95SIM120

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768


РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95SIM120



Катетер доставки BENCHMARK

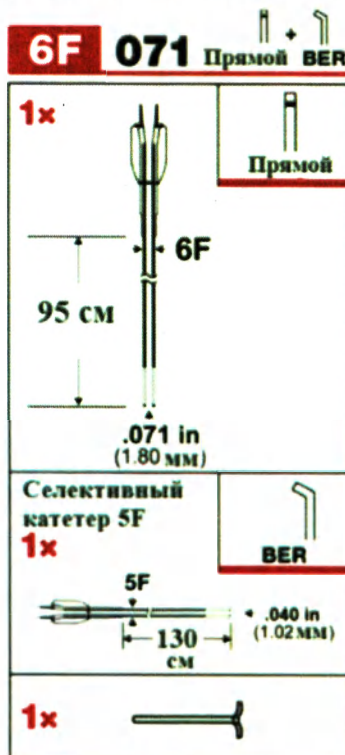

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F95BER130

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768


РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95BER130



Катетер доставки BENCHMARK

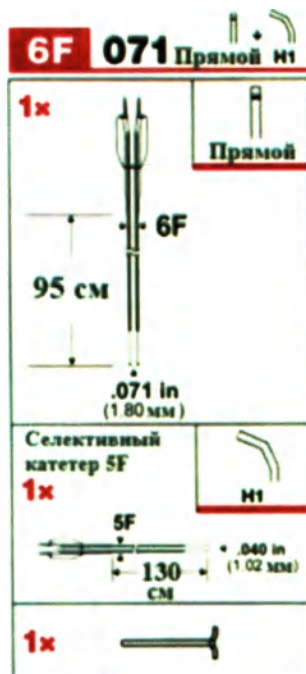

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F95H1130

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768


РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95H1130



Катетер доставки BENCHMARK

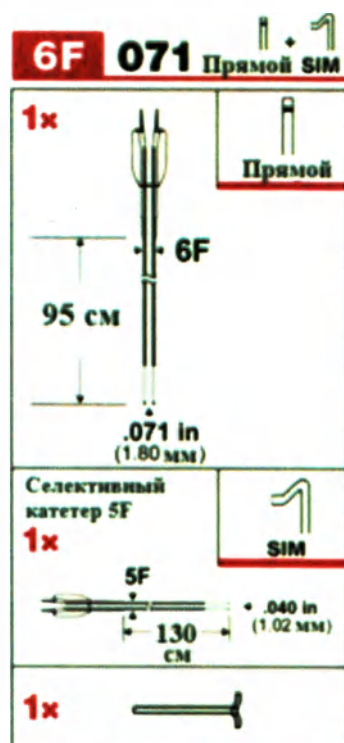

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F95SIM130

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95SIM130



Катетер доставки BENCHMARK

6F 071 Изогнутый BER

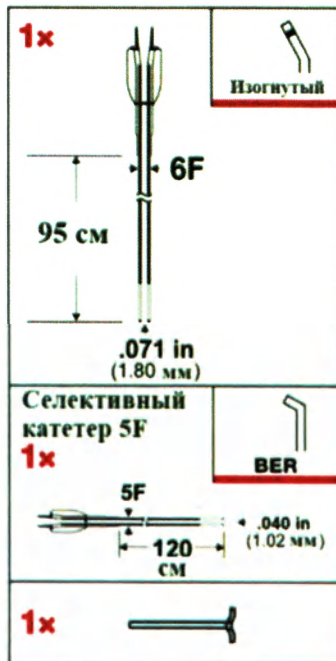

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F95MBER120

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768


РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MBER120



Катетер доставки BENCHMARK

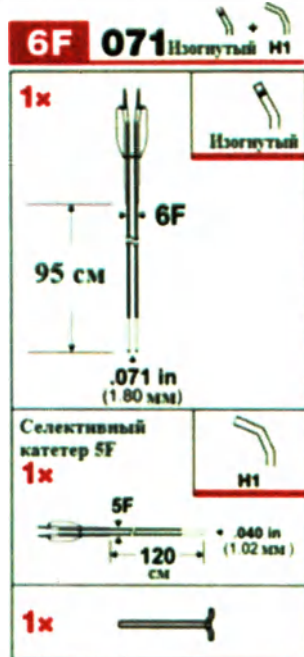

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232



Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany



BMK6F95MH1120



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MH1120



Катетер доставки BENCHMARK

6F 071 Изогнутый SIM

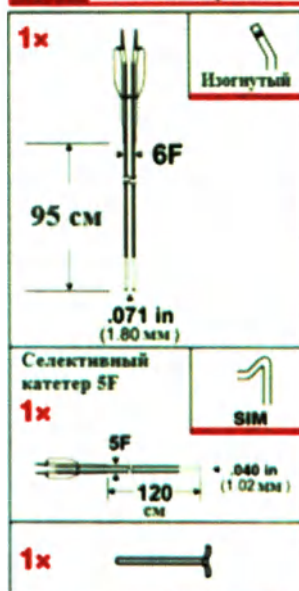

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F95MSIM120

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MSIM120



Катетер доставки BENCHMARK

6F 071 Изогнутый BER

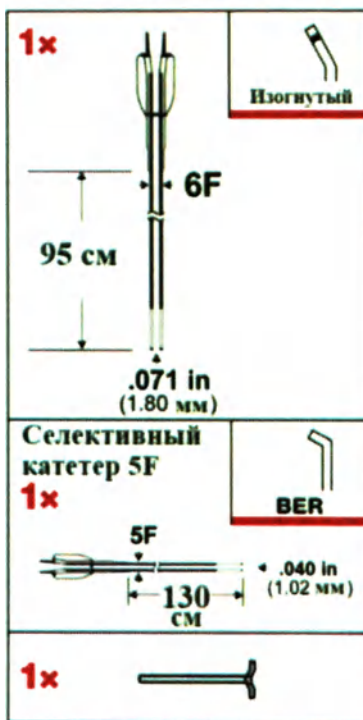

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA

Tel: 1.888.272.4606

1.510.748.3200

Fax: 1.510.748.3232

REF

BMK6F95MBER130

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768


РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MBER130

Penumbra 

Катетер доставки BENCHMARK

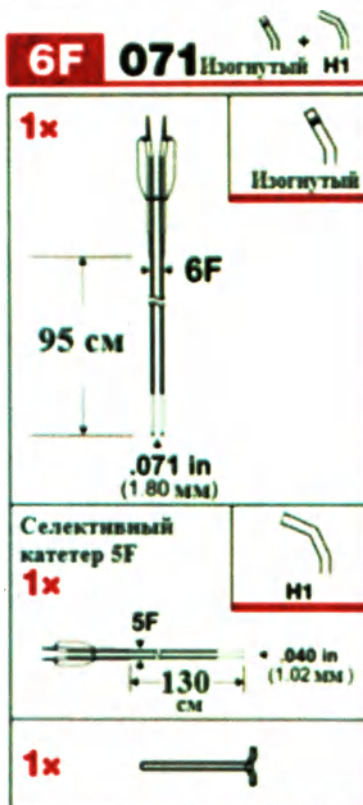

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F95MH1130

LOT

См. информацию на оригинальной маркировке на английском языке

См. штрихкод на оригинальной маркировке на английском языке

См. информацию на оригинальной маркировке на английском языке

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MH1130



Катетер доставки BENCHMARK

6F 071 Изогнутый SIM

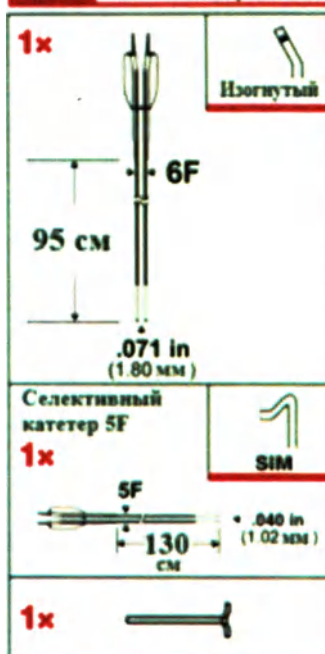

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F95MSIM130

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768


РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F95MSIM130



Катетер доставки BENCHMARK

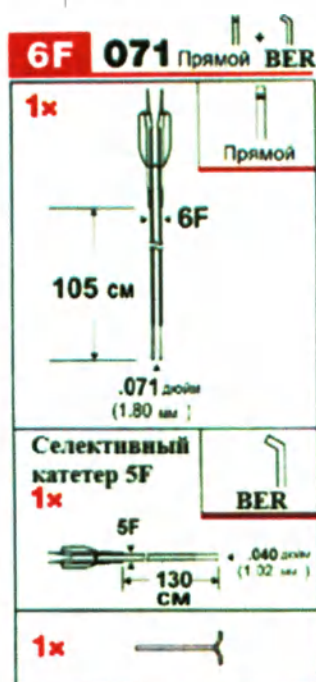

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F105BER130

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768


РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105BER130

Penumbra 

Катетер доставки BENCHMARK

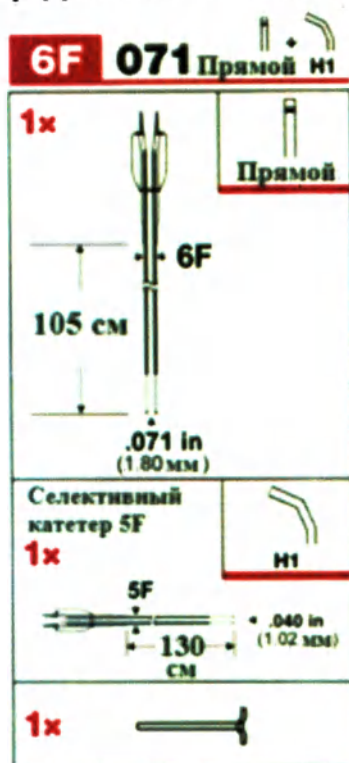

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F105H1130

LOT

См. информацию на оригинальной маркировке на английском языке

См. штрихкод на оригинальной маркировке на английском языке



См. информацию на оригинальной маркировке на английском языке

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768


ПУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105H1130



Катетер доставки BENCHMARK

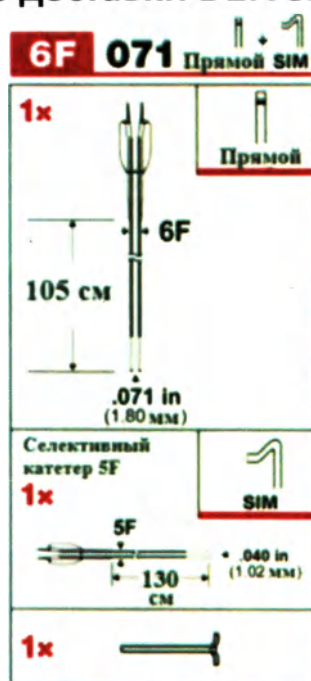

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F105SIM130

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105SIM130

Penumbra 

Катетер доставки BENCHMARK

6F 071 Изогнутый BER

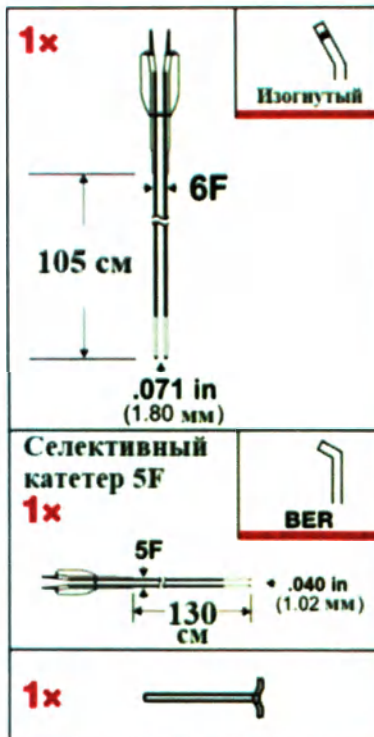

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA

Tel: 1.888.272.4606

1.510.748.3200

Fax: 1.510.748.3232

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F95MBER130

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке


Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105MBER130

Катетер доставки BENCHMARK

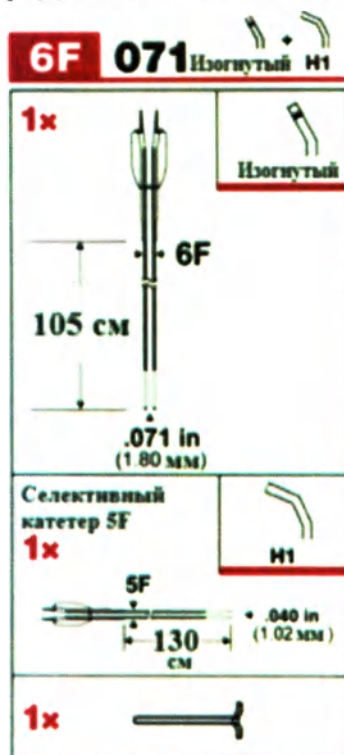

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F105MH1130

LOT

См. информацию на оригинальной маркировке на английском языке

См. штрихкод на оригинальной маркировке на английском языке



См. информацию на оригинальной маркировке на английском языке

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768


РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105MH1130



Катетер доставки BENCHMARK

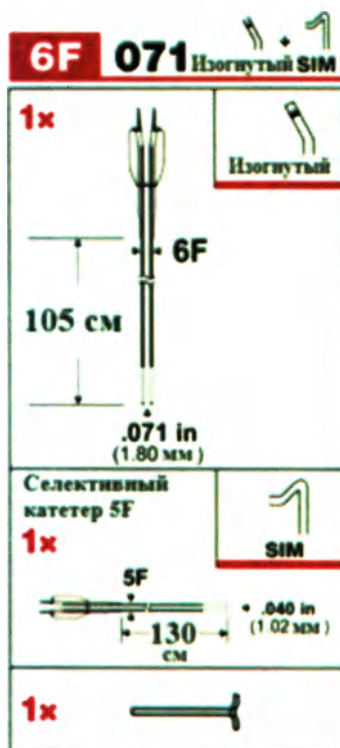

EC REP



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

BMK6F105MSIM130

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
BMK6F105MSIM130

Penumbra 

Катетер доставки BENCHMARK

5F

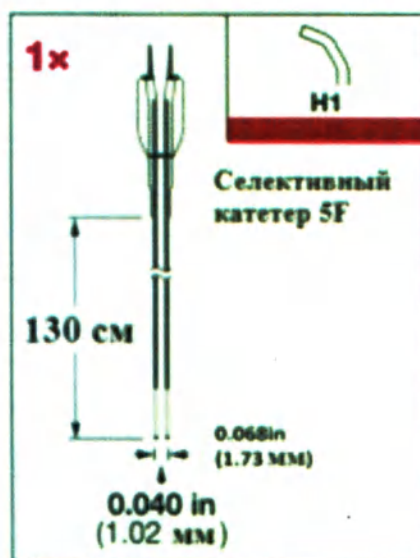

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

PNS5F130H1

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: PNS5F130H1

Penumbra 

Катетер доставки BENCHMARK

5F

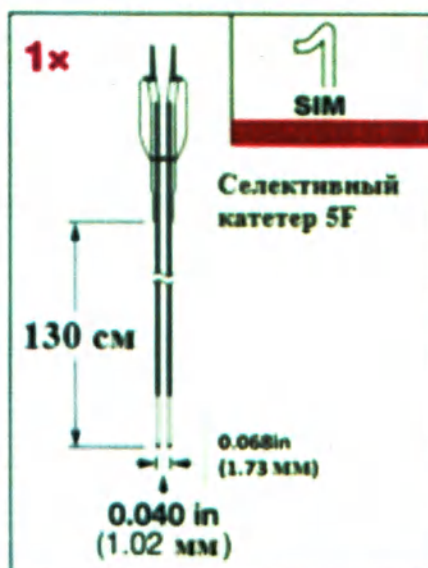

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

PNS5F130SIM

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
PNS5F130SIM



Катетер доставки BENCHMARK

5F

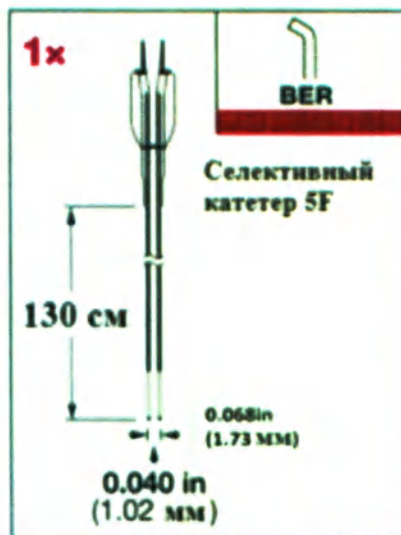

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

PNS5F130BER

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
PNS5F130BER

Penumbra 

Катетер доставки BENCHMARK

5F

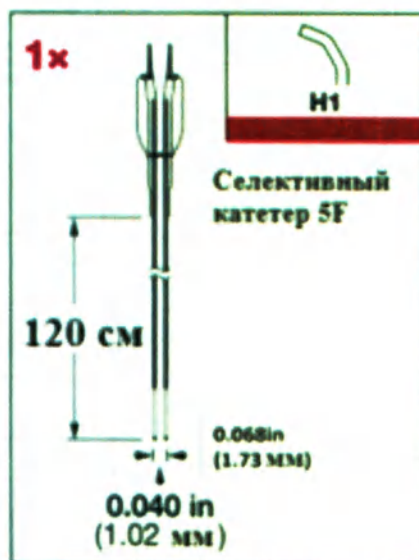

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

PNS5F120H1

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения: PNS5F120H1



Катетер доставки BENCHMARK

5F

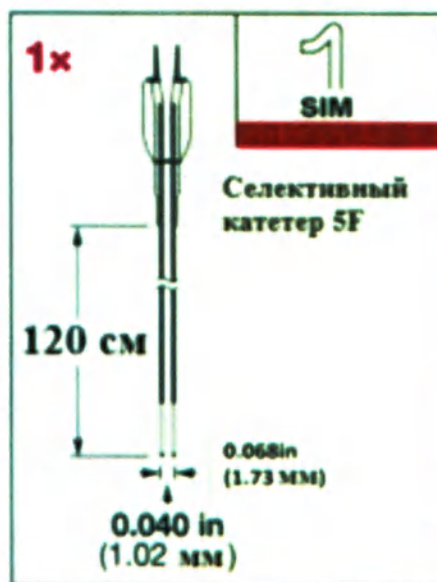

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

PNS5F120SIM

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке



См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101, стр 1, пом 17,
Тел.: +7(499)2816768

РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021


Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
PNS5F120SIM



Катетер доставки BENCHMARK

5F

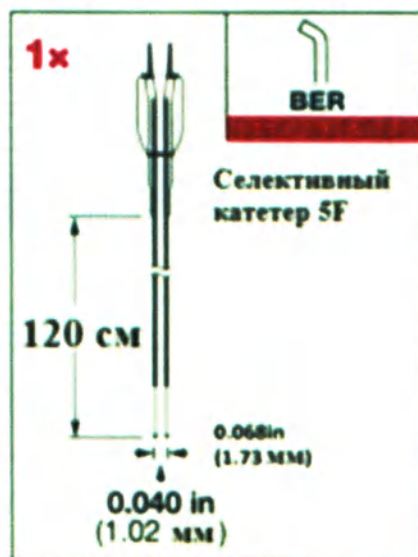

Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

EC REP

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin, Germany

REF

PNS5F120BER

LOT

См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

См. штрихкод на
оригинальной маркировке
на английском языке




См. информацию на
оригинальной маркировке
на английском языке

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Компания БиВи»
129085, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ
Останкинский, пр-кт Мира,
д. 101 стр. 1, помещ. 1/1.
Тел.: +7(499)2816768
РУ № РЗН 2016/5211 от 15.11.2021

Pat. www.penumbrainc.com/patents

Маркировка (стикер для РФ). Катетер доставки Benchmark. Вариант исполнения:
PNS5F120BER

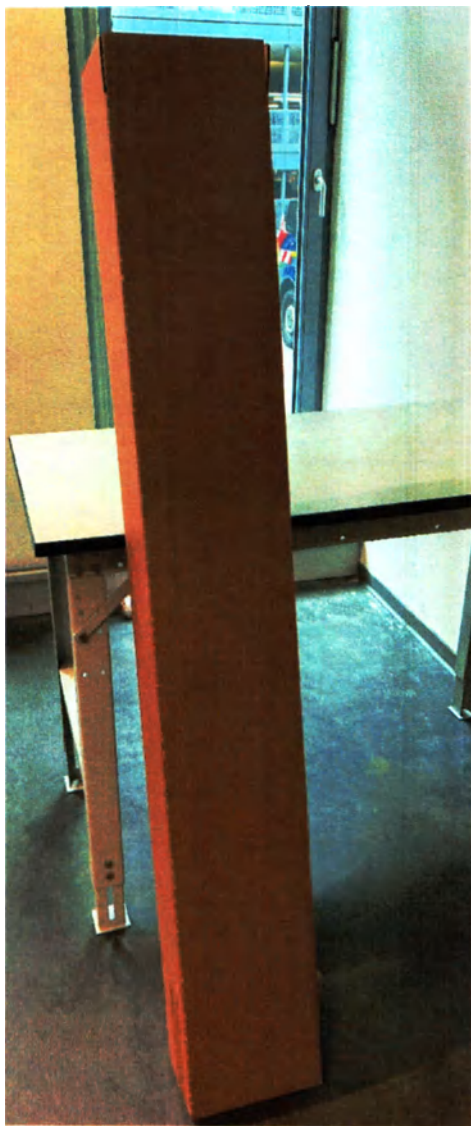

Транспортная упаковка



Транспортная маркировка

Катетер доставки Benchmark


REF	LOT		Количество, шт
BMK6F105	F12345	2025-12-04	6
BMK6F105M	F12347	2025-12-05	2



Penumbra, Inc.
("Пенумбра, Инк.")
One Penumbra Place
Alameda, CA 94502, USA
Tel: 1.888.272.4606
1.510.748.3200
Fax: 1.510.748.3232

Rx Only

STERILE EO



нетоксично

Макет маркировки транспортной упаковки

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 69 листа (-ов)

Генеральный Директор НУ / Носова Т.А.
М.П.



МИТРОХИНА Ю.Ю.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АД6134-7