

Фотографические изображения медицинского изделия

Эндоскопы гибкие для исследования желудочно-кишечного тракта,
с принадлежностями

Производства FUJIFILM Corporation, Япония

«УТВЕРЖДАЮ»

Младший специалист группы регистрации
медицинских изделий Департамента
регистрации лекарственных средств и
медицинских изделий Медицинской дирекции

АО «Р-Фарм»

(на основании Доверенности № 579 от 29.12.2023 г.)

Е.М. Чикунова

« 12 » сентября 2024 г.







**Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного
тракта: Гастроскоп**

Модель: EG-720R

Производитель:

ФУДЖИФИЛЬМ
Корпорейшн,
Япония

FUJIFILM
Corporation,
Japan

Страна

происхождения:

Уполномоченный

представитель


производителя в РФ:

АО «Р-Фарм»
123154, Москва,
ул. Берзарина, д. 19, корп. 1,
тел. 8-495-956-79-37
факс: 8-495-956-79-38
e-mail: info@rpharm.ru

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.


Гастроскоп, в исполнении: EG-720R.

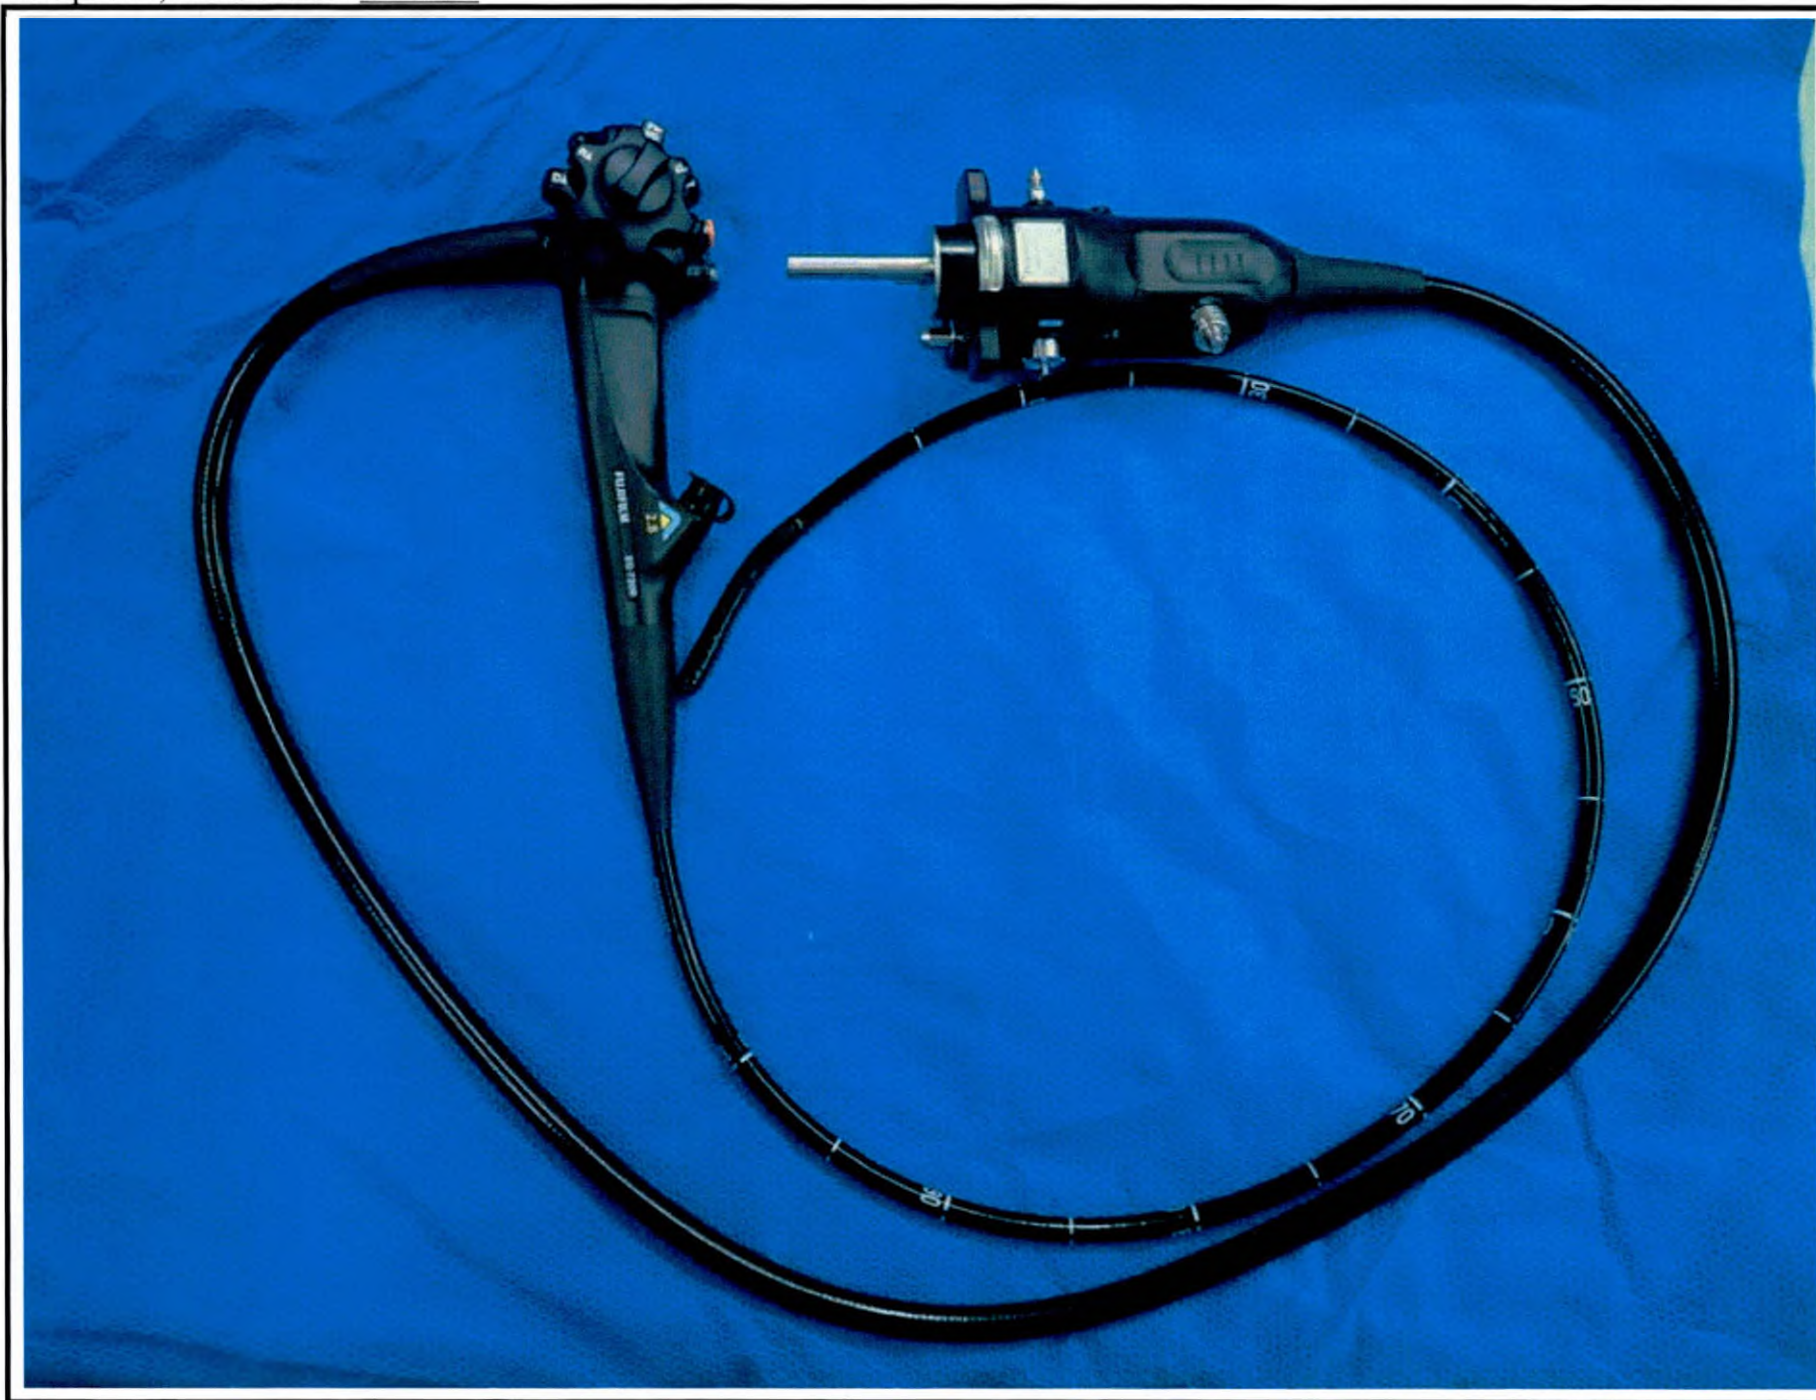


Гастроскоп, в исполнении: EG-720R.



Гастроскоп, в исполнении: EG-720R.

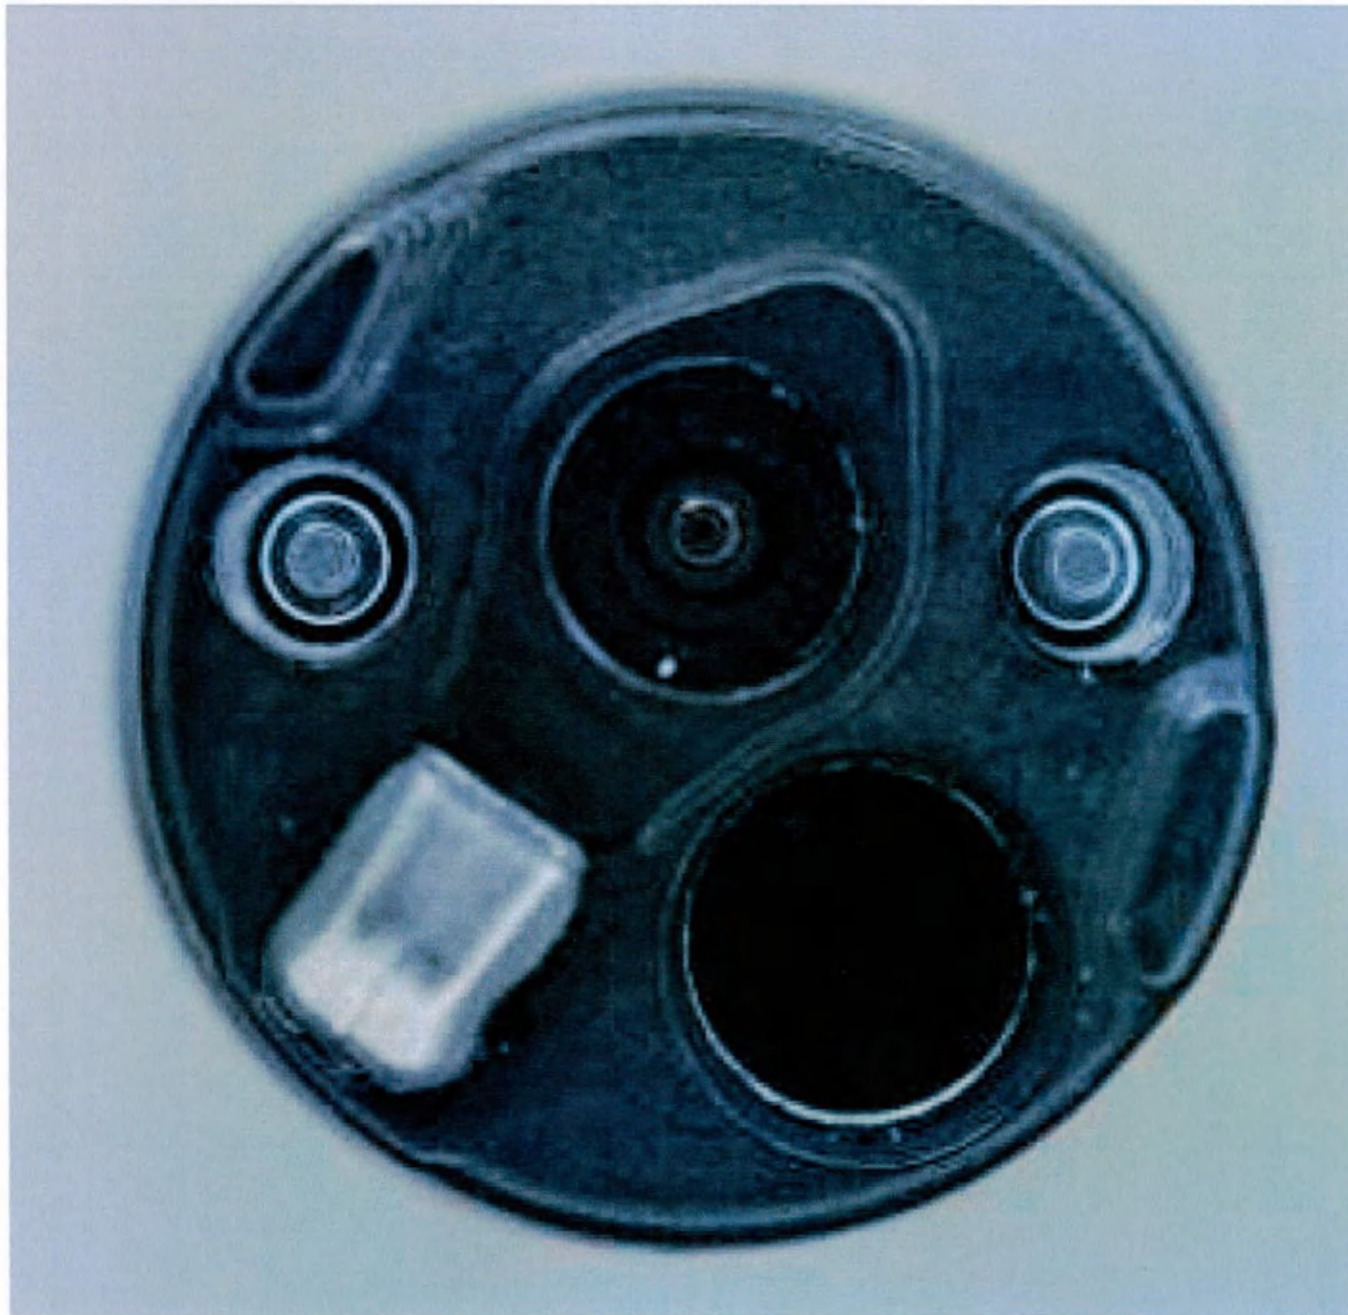


Гастроскоп, в исполнении: EG-740N.

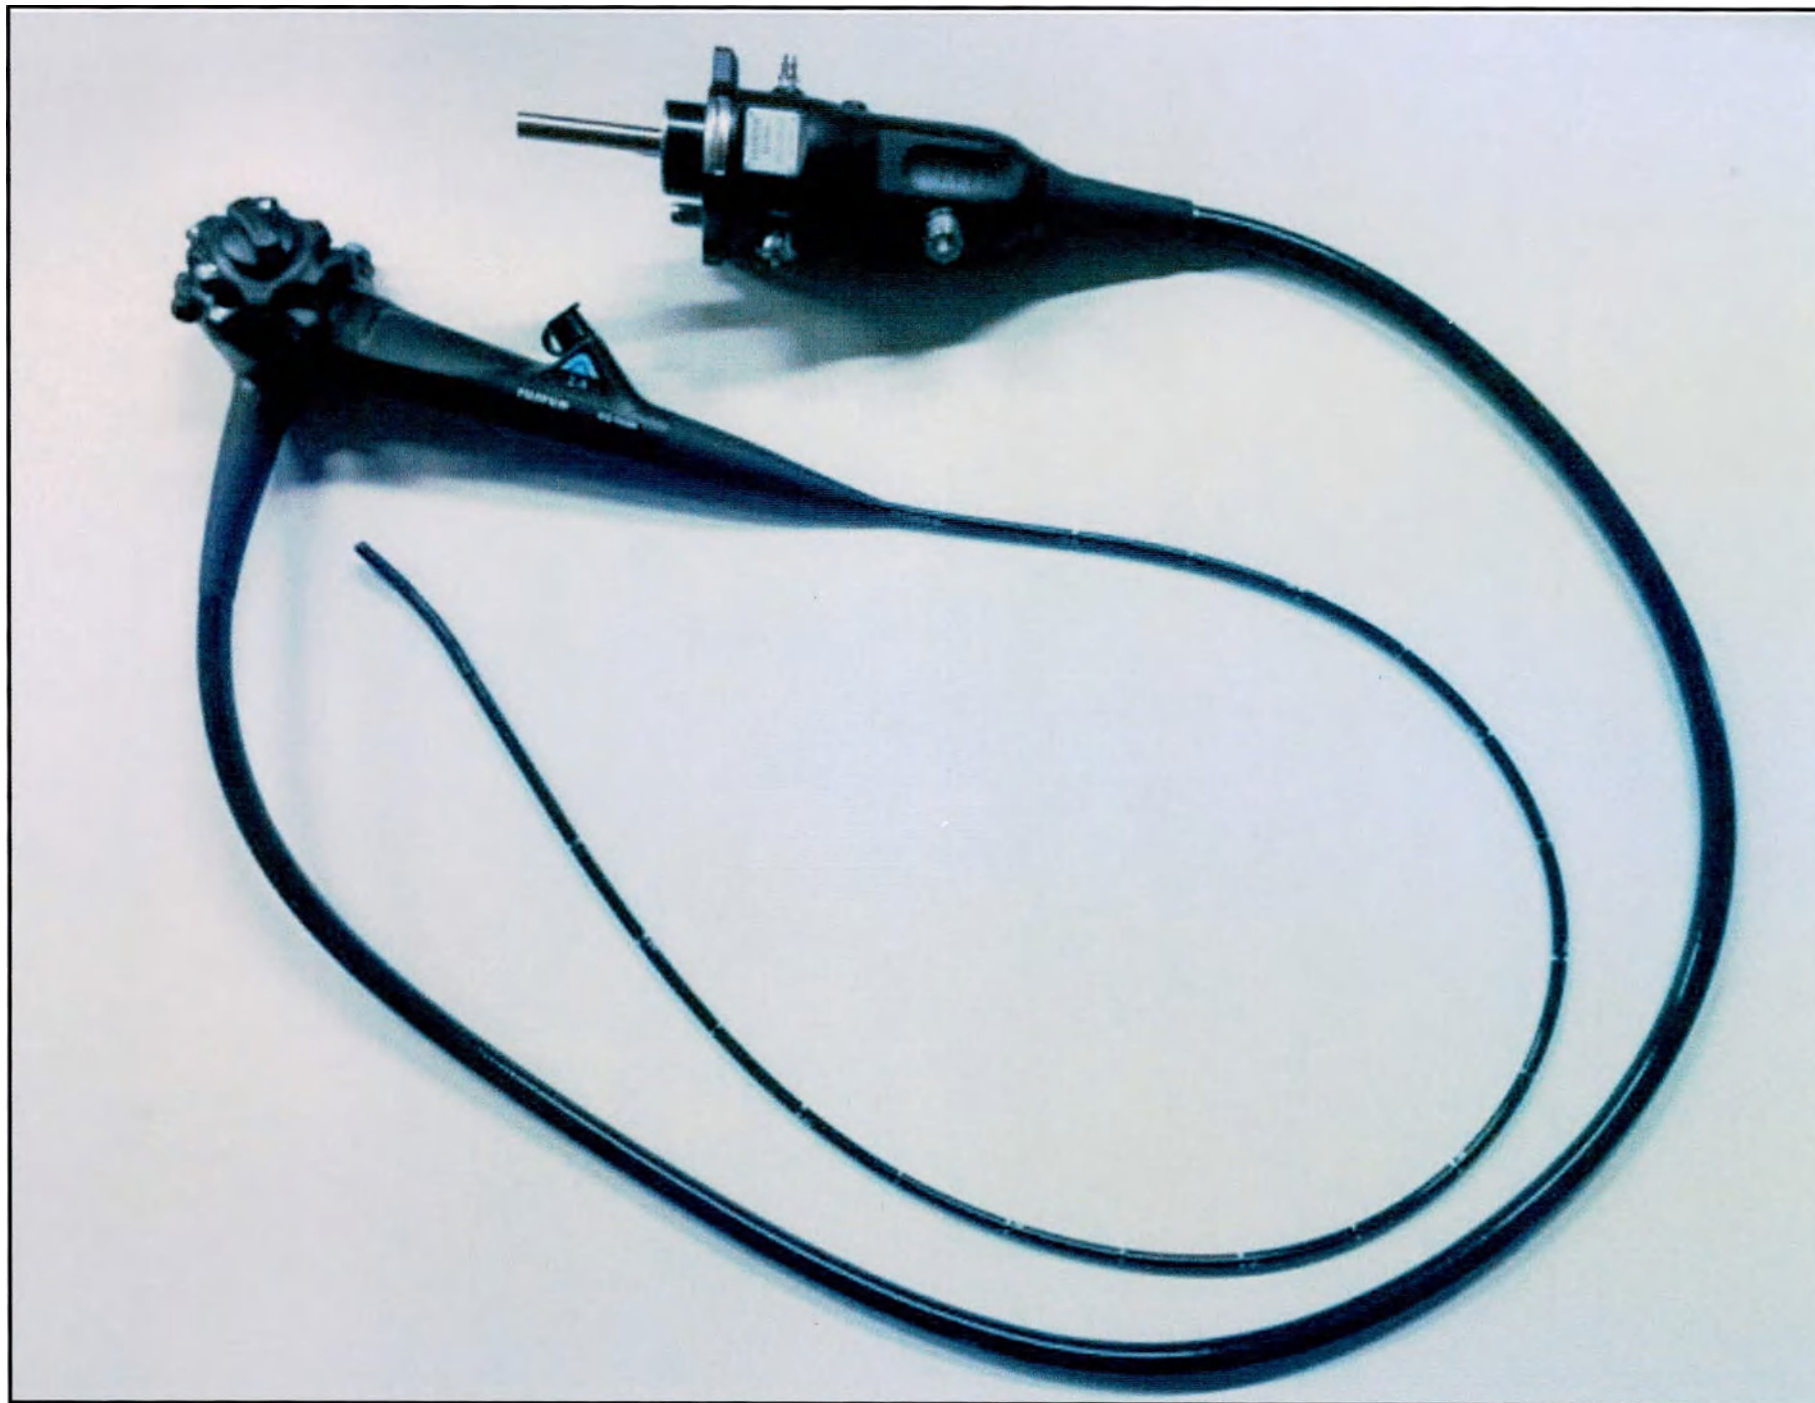

Гастроскоп, в исполнении: EG-740N.



Гастроскоп, в исполнении: EG-740N.

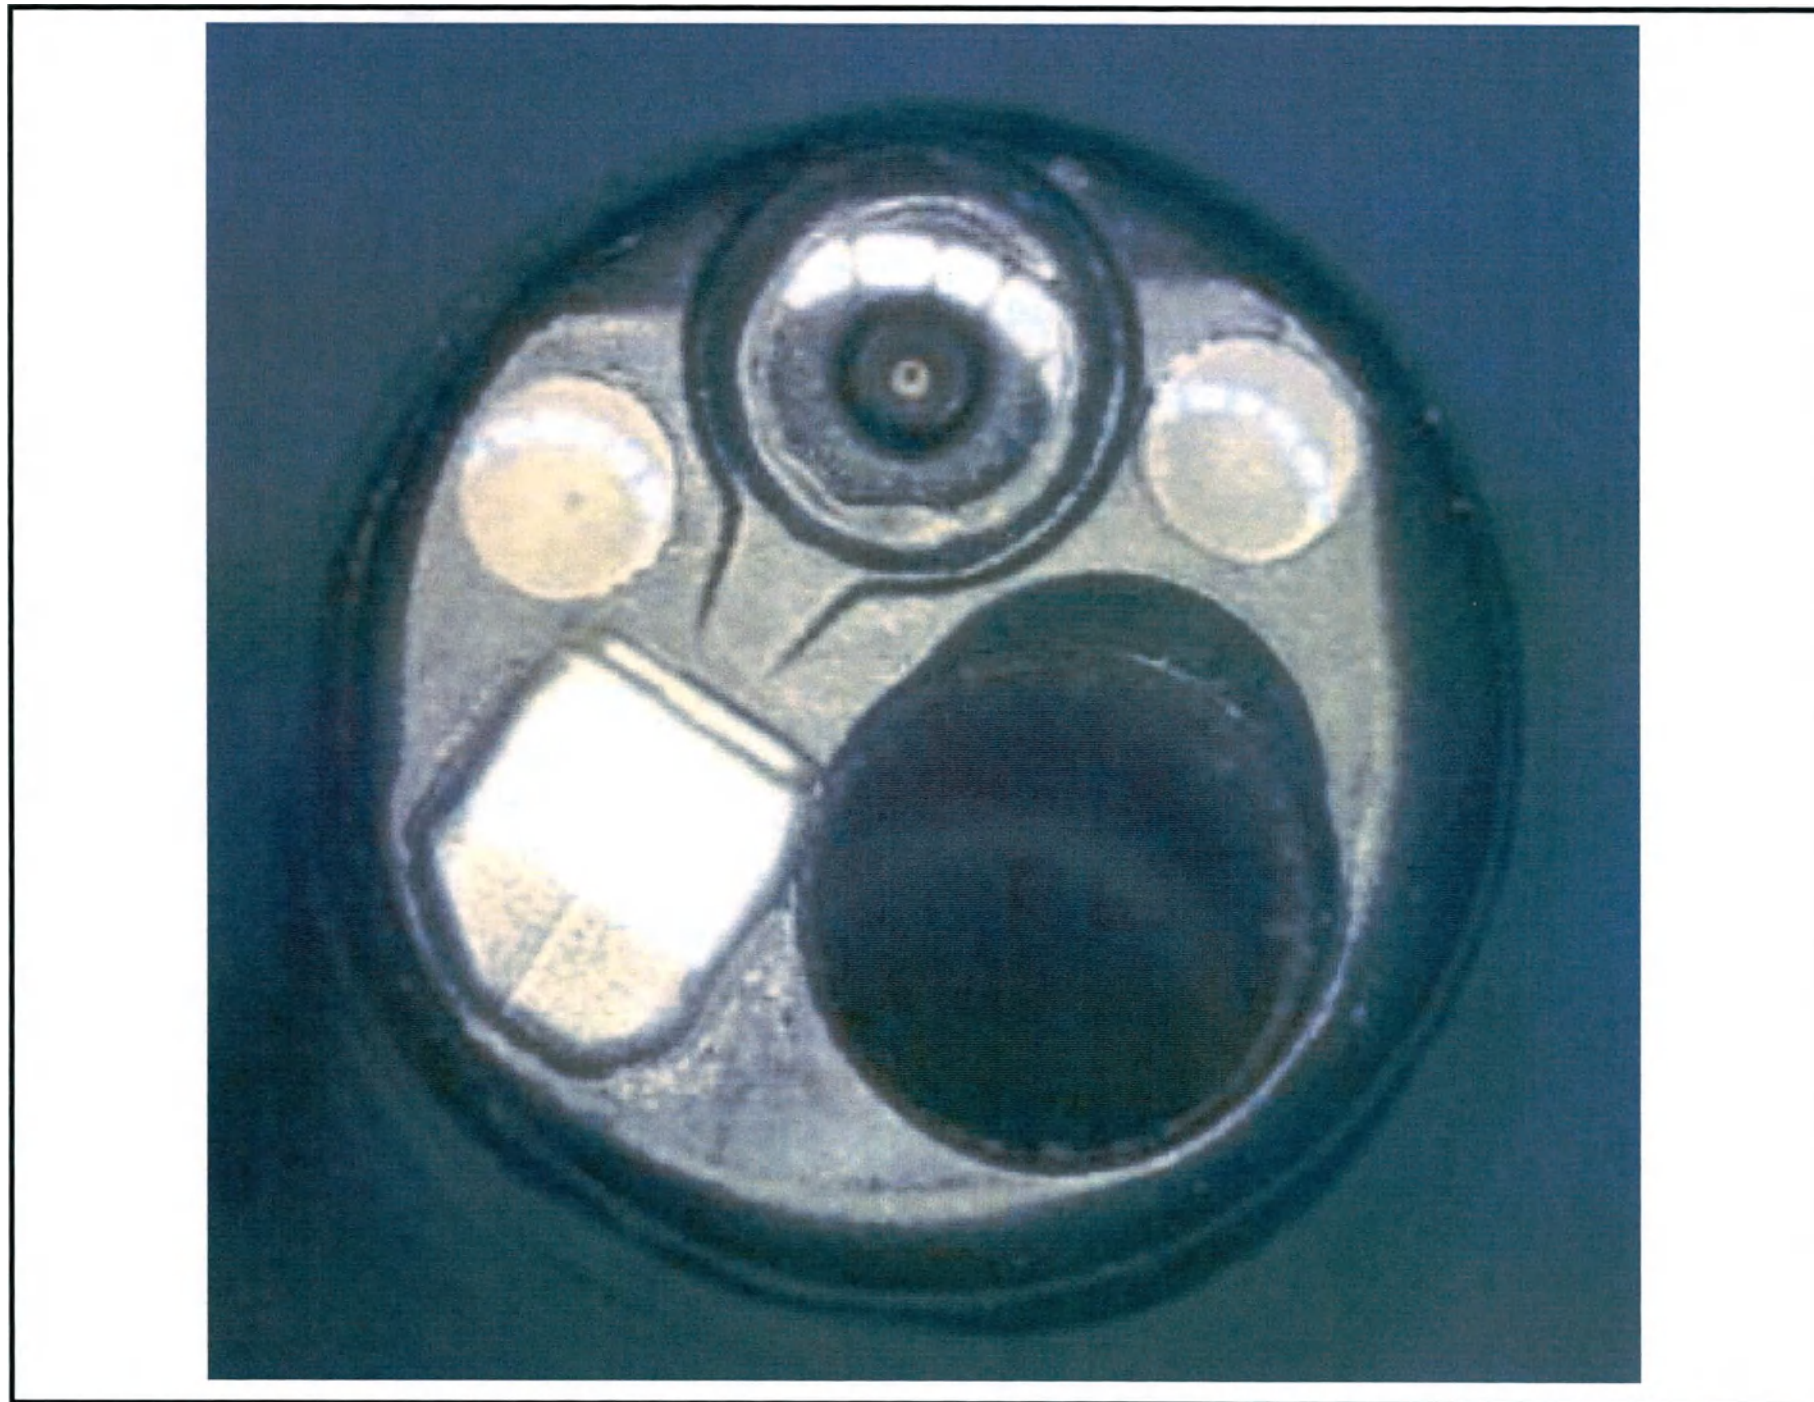

**Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного
тракта: Дуоденоскоп**

Модель: ED-530XT8

Производитель:

ФУДЖИФИЛЬМ

FUJIFILM

Корпорейшн,

Corporation,

Япония

Japan

**Страна
происхождения:**

Уполномоченный

АО «Р-Фарм»

представитель

123154, Москва,

производителя в РФ:

ул. Берзарина, д. 19, корп. 1,

тел. 8-495-956-79-37


факс: 8-495-956-79-38

e-mail: info@rpharm.ru


Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Дуоденоскоп, в исполнении: ED-530XT8.

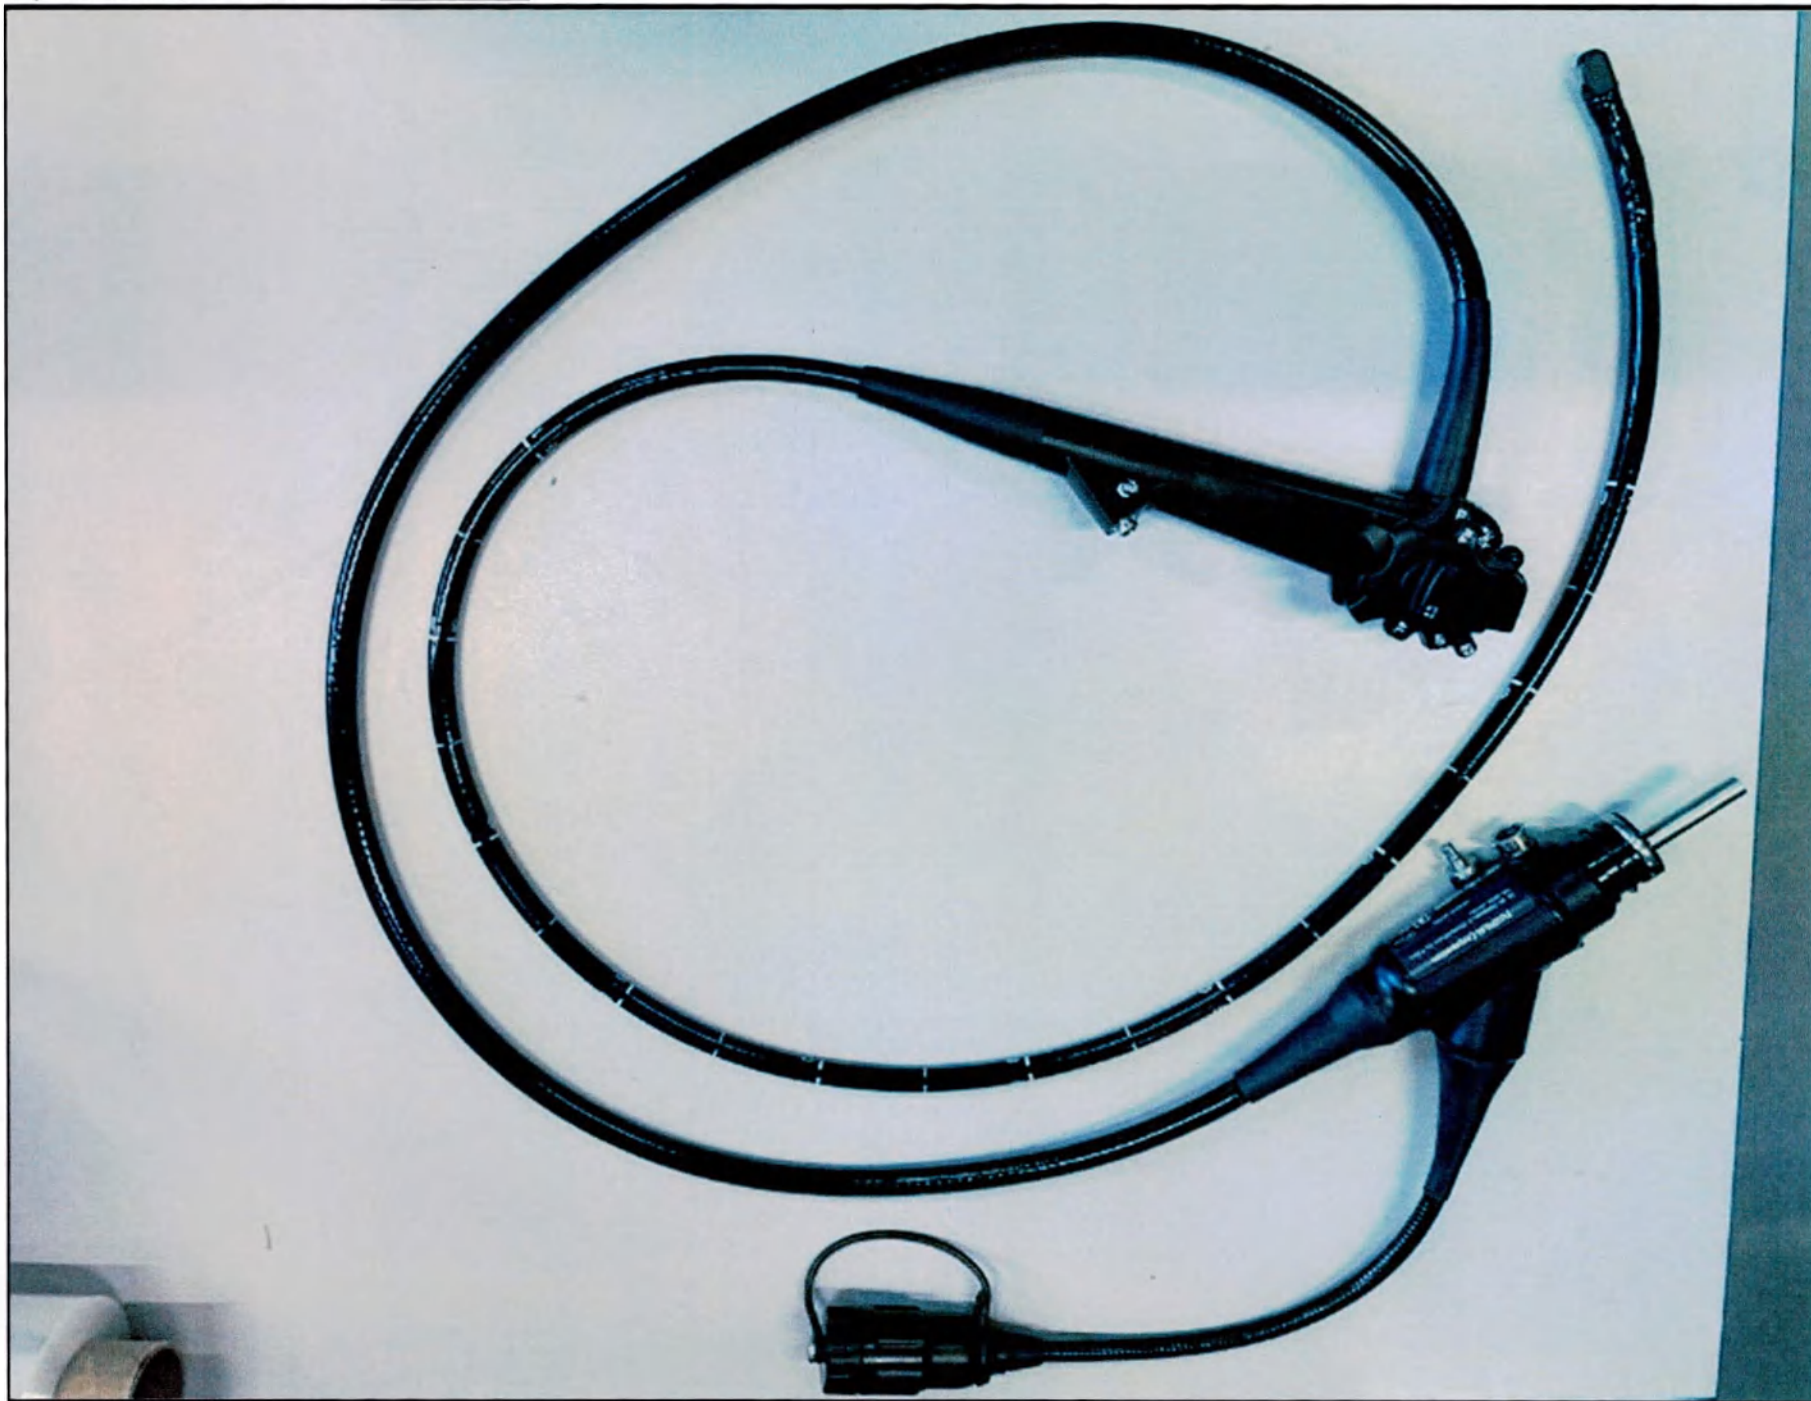


Дуоденоскоп, в исполнении: ED-530XT8.

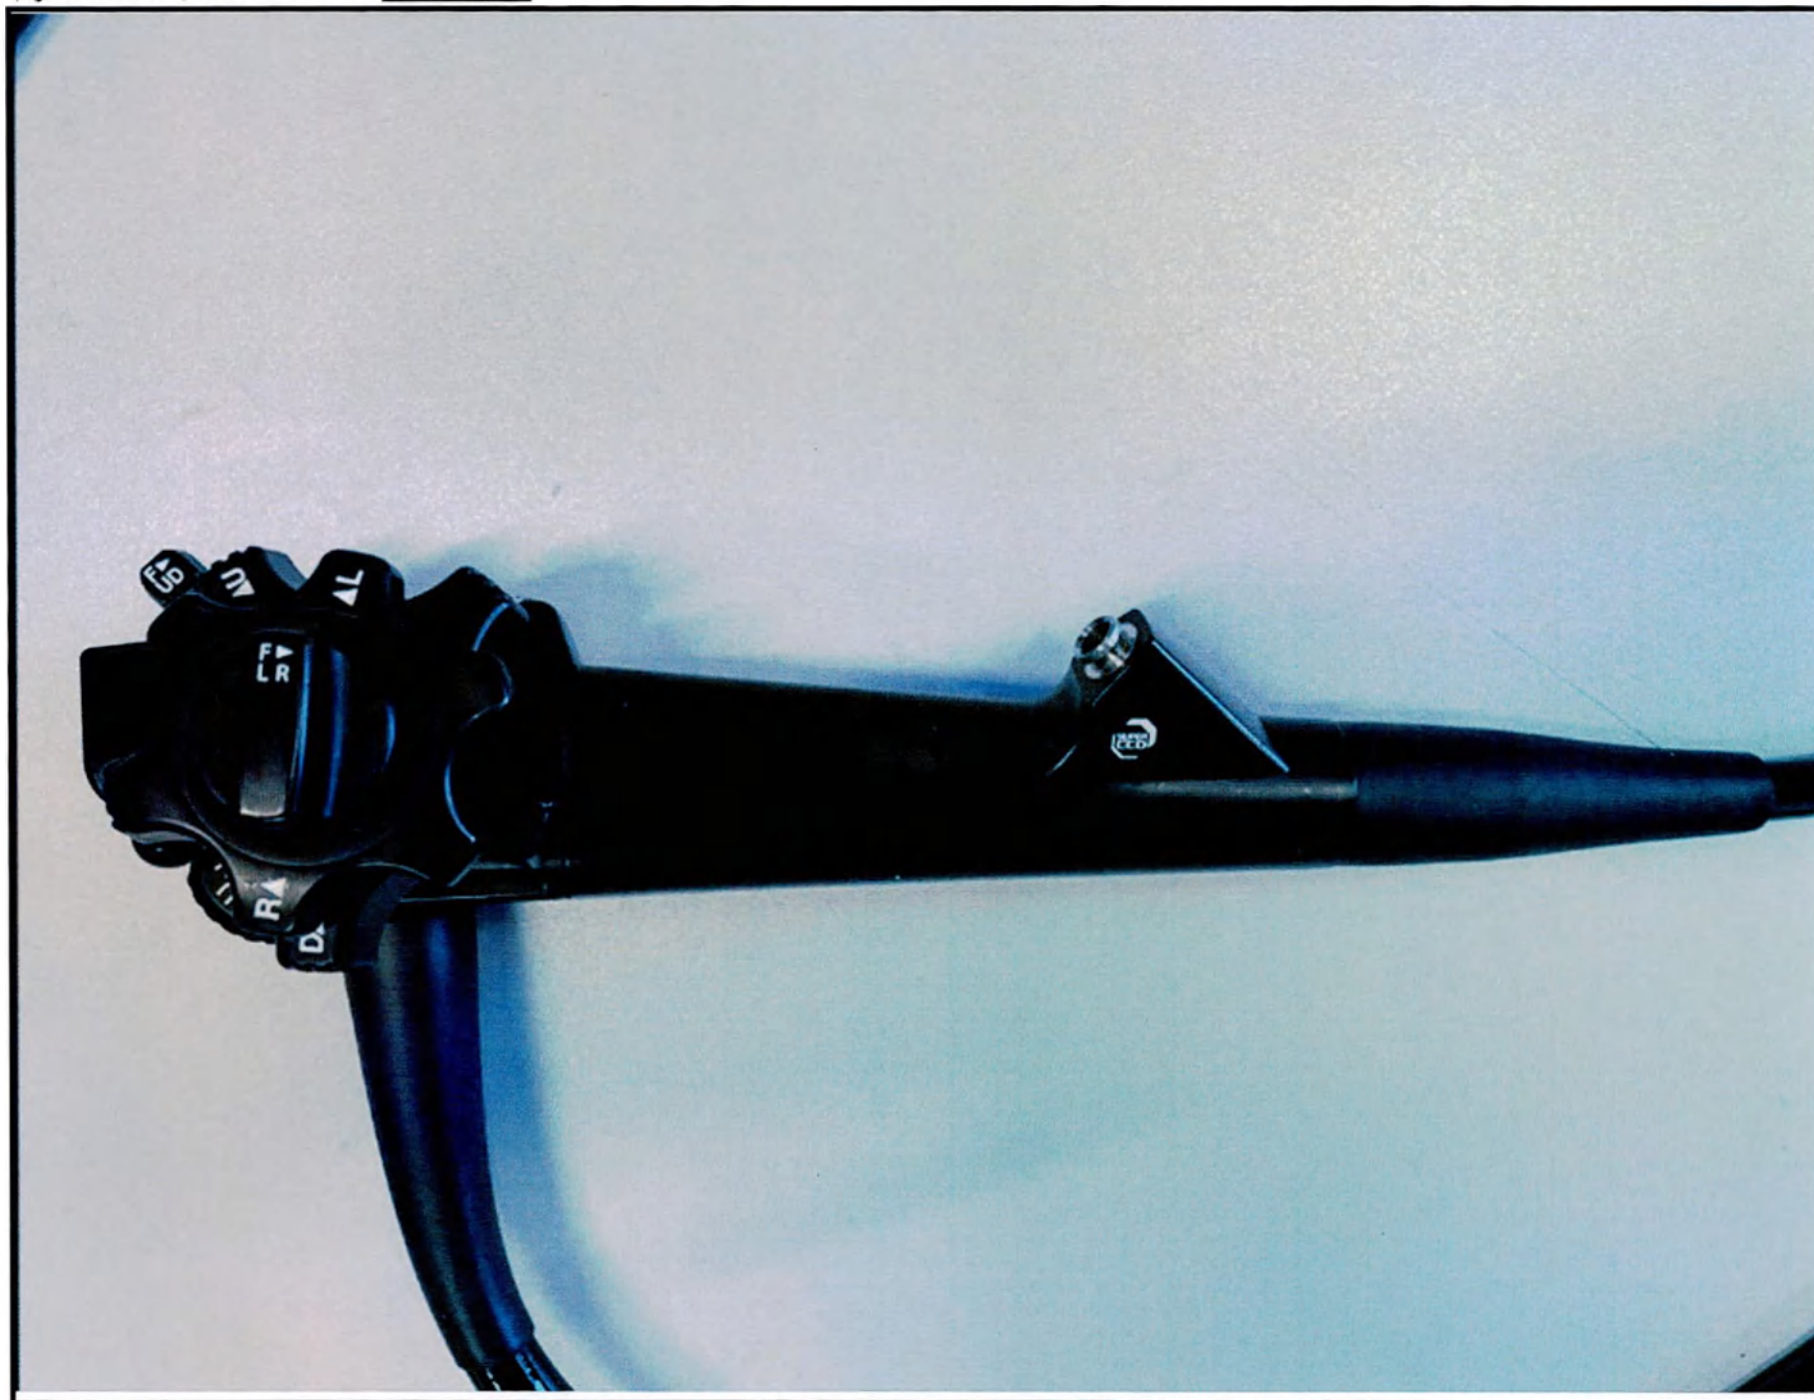


Дуоденоскоп, в исполнении: ED-530XT8.




Дуоденоскоп, в исполнении: ED-580T.

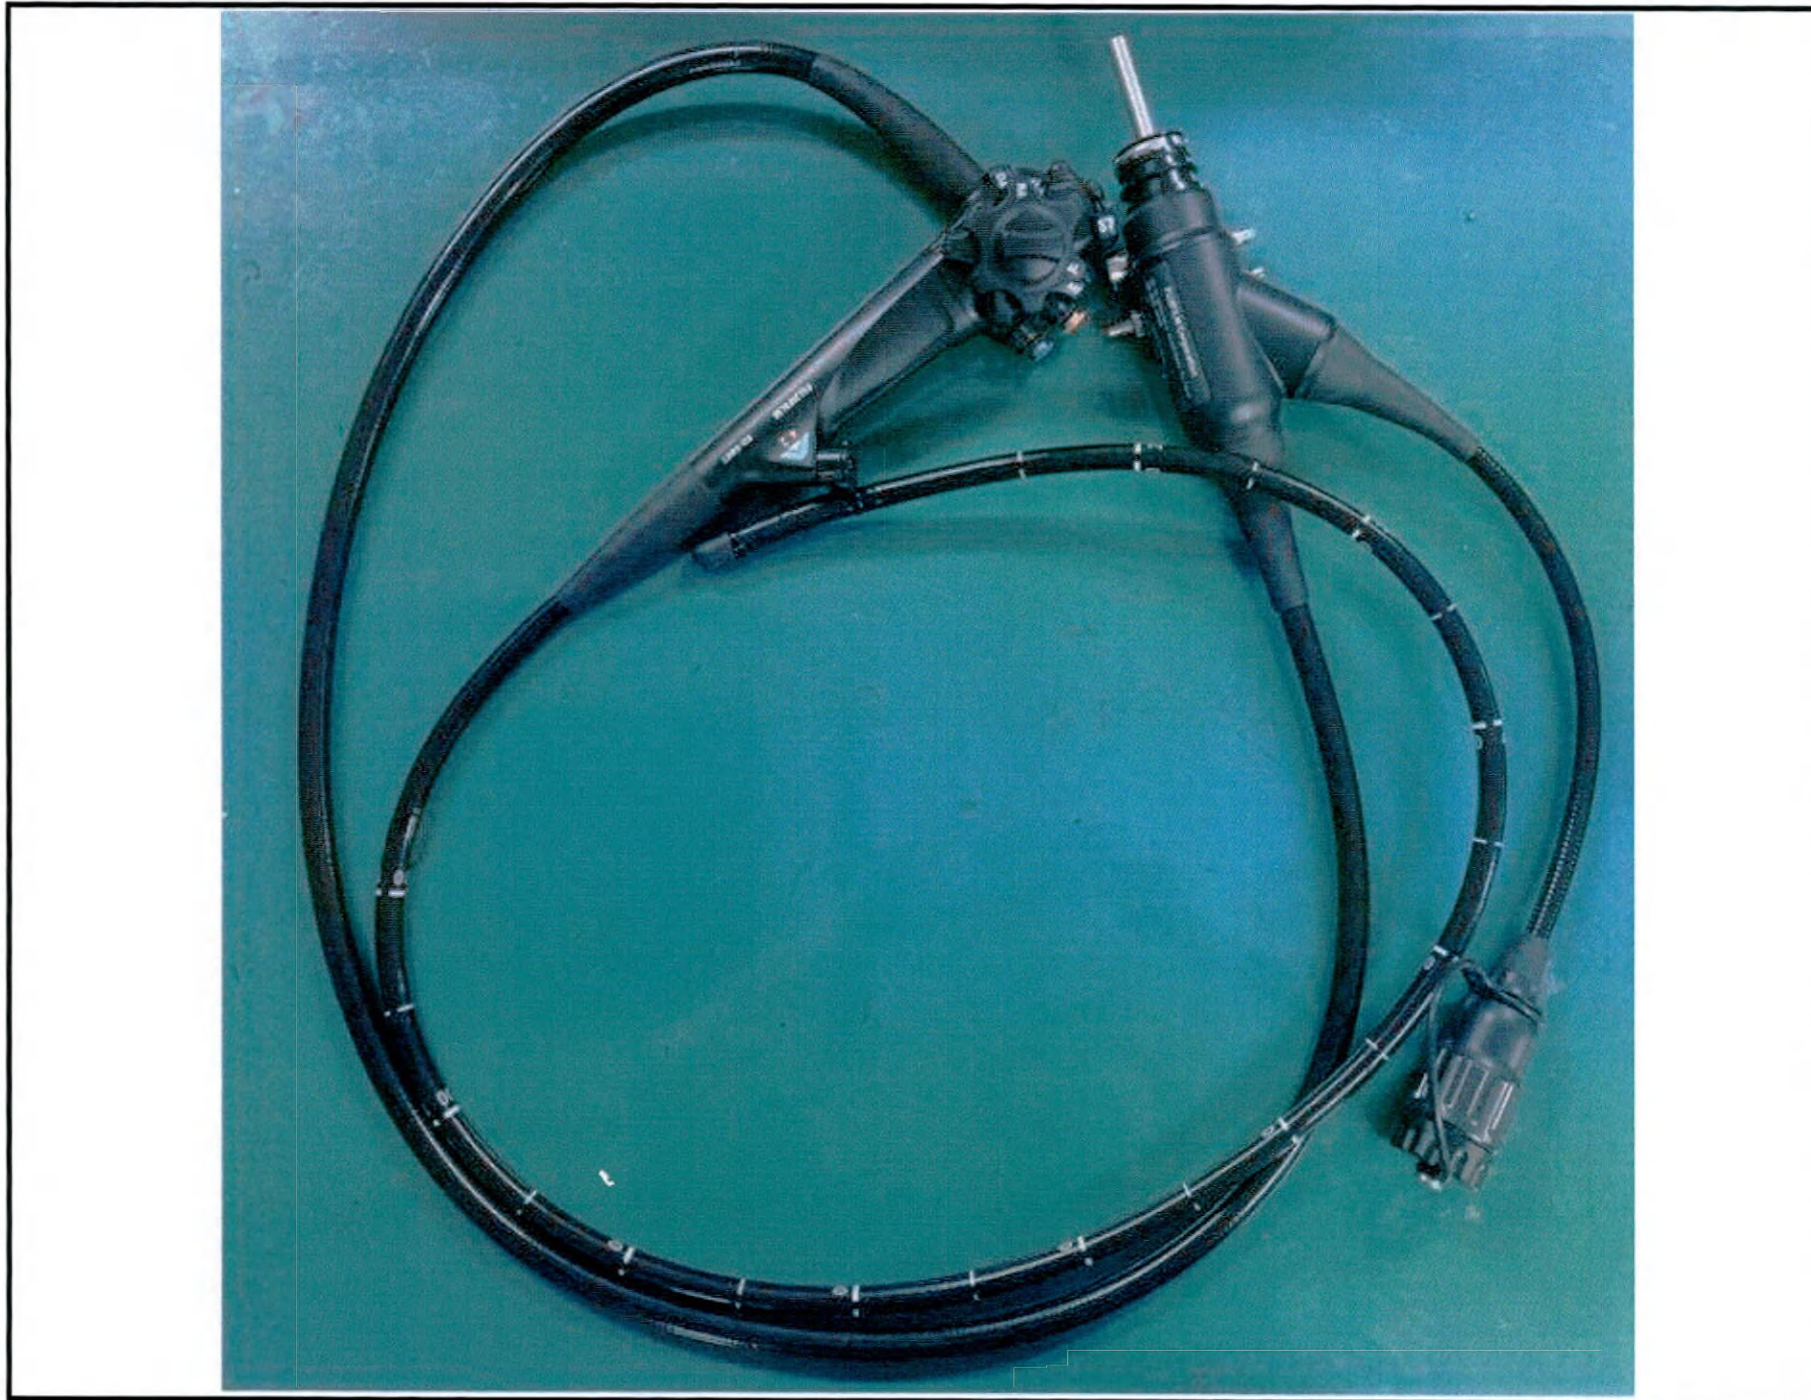


Дуоденоскоп, в исполнении: ED-580T.

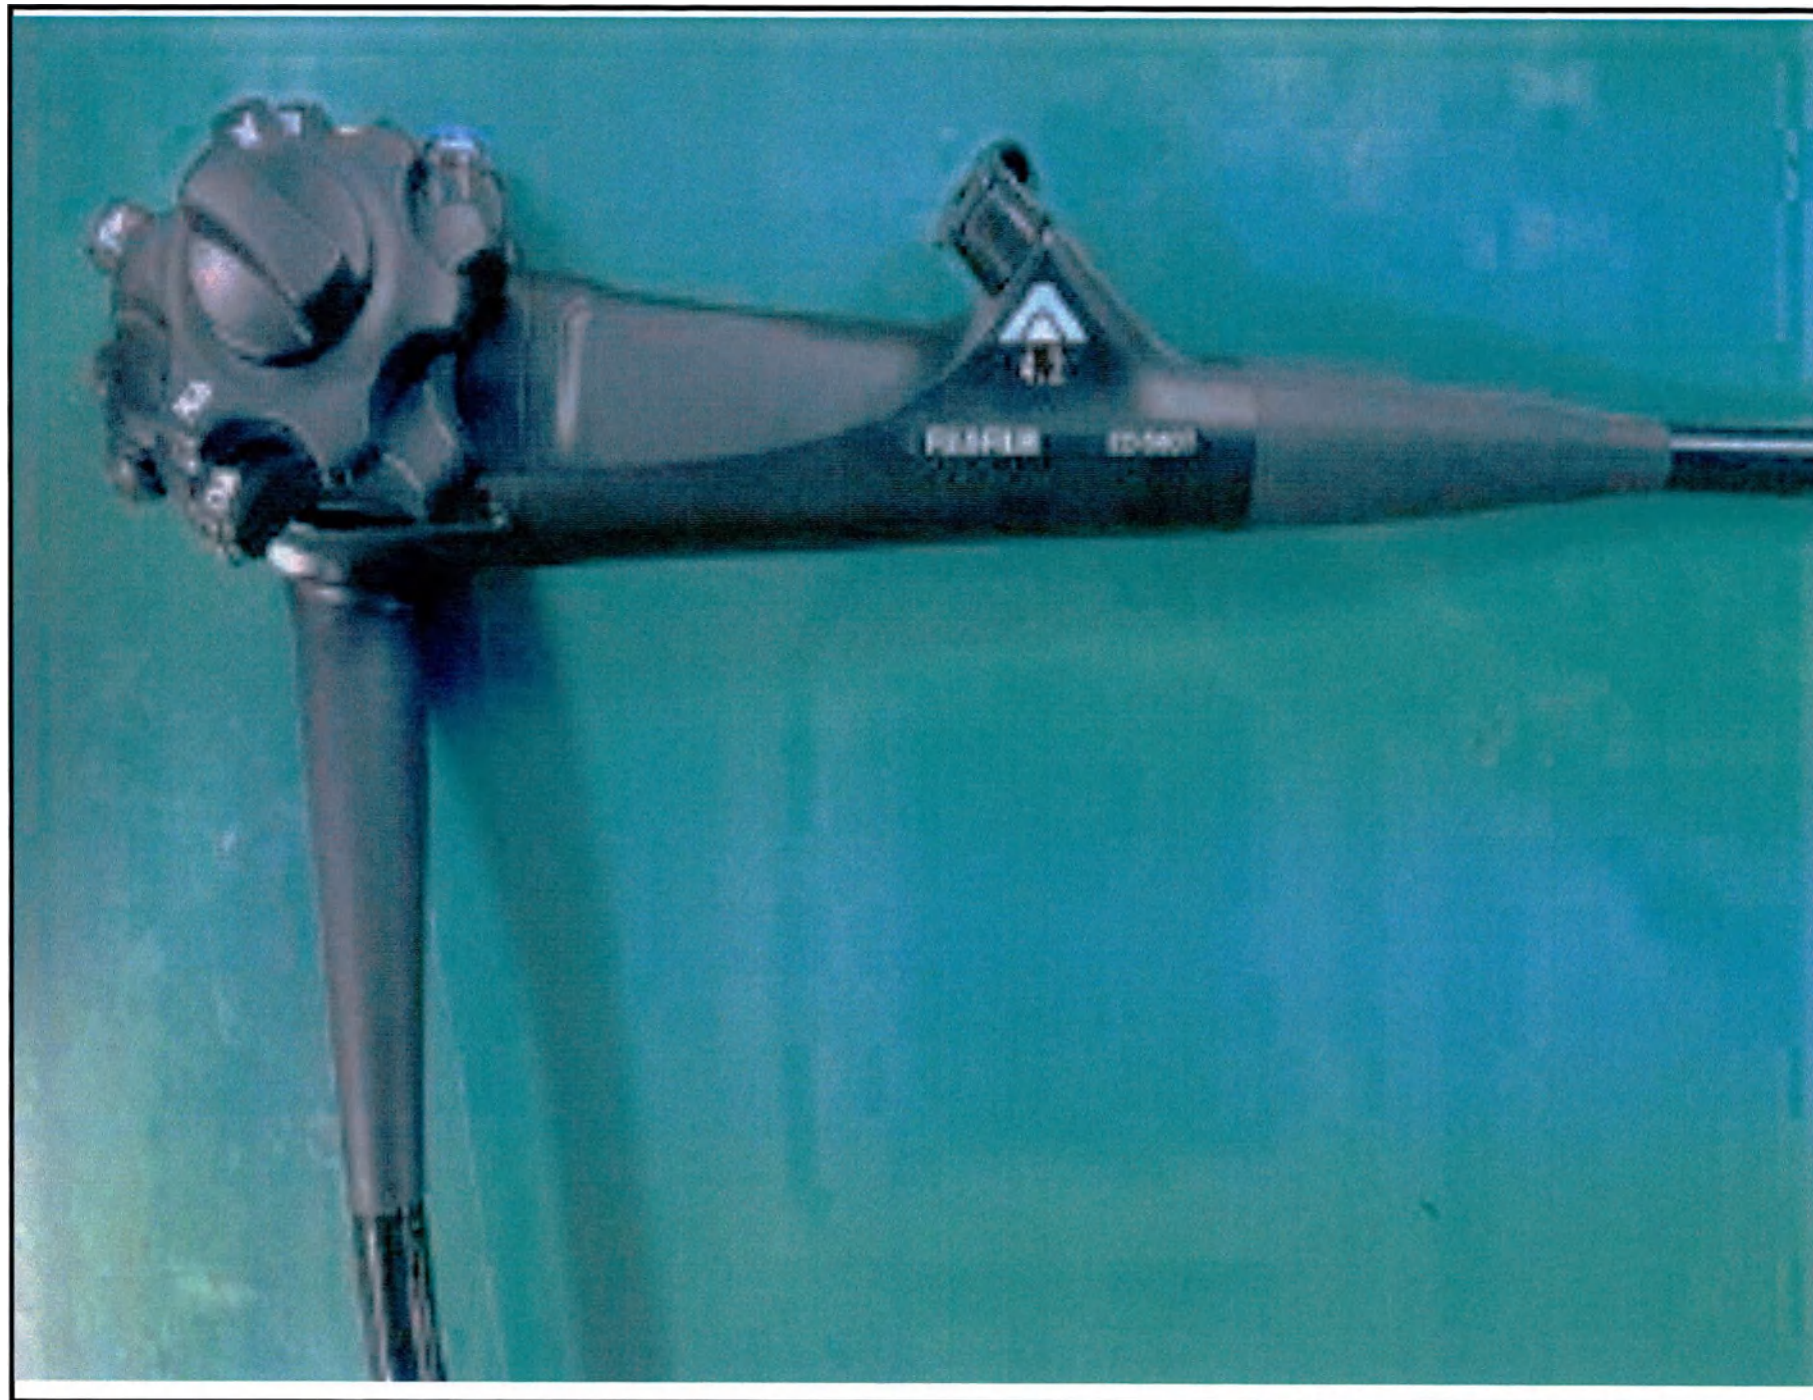

Дуоденоскоп, в исполнении: ED-580T.

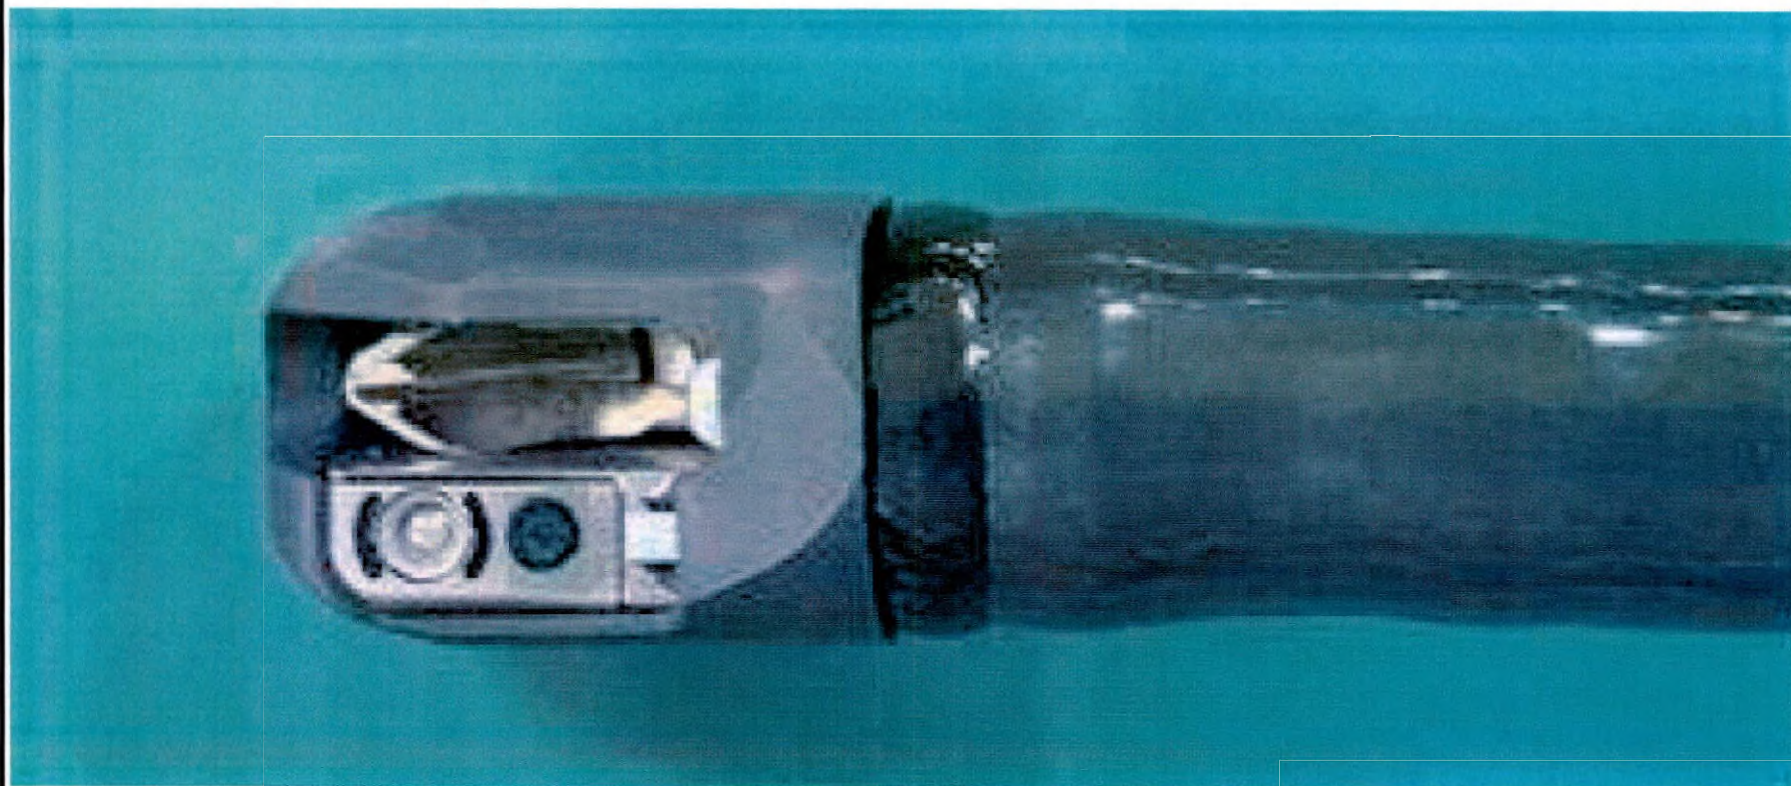


Дуоденоскоп, в исполнении: ED-580XT.

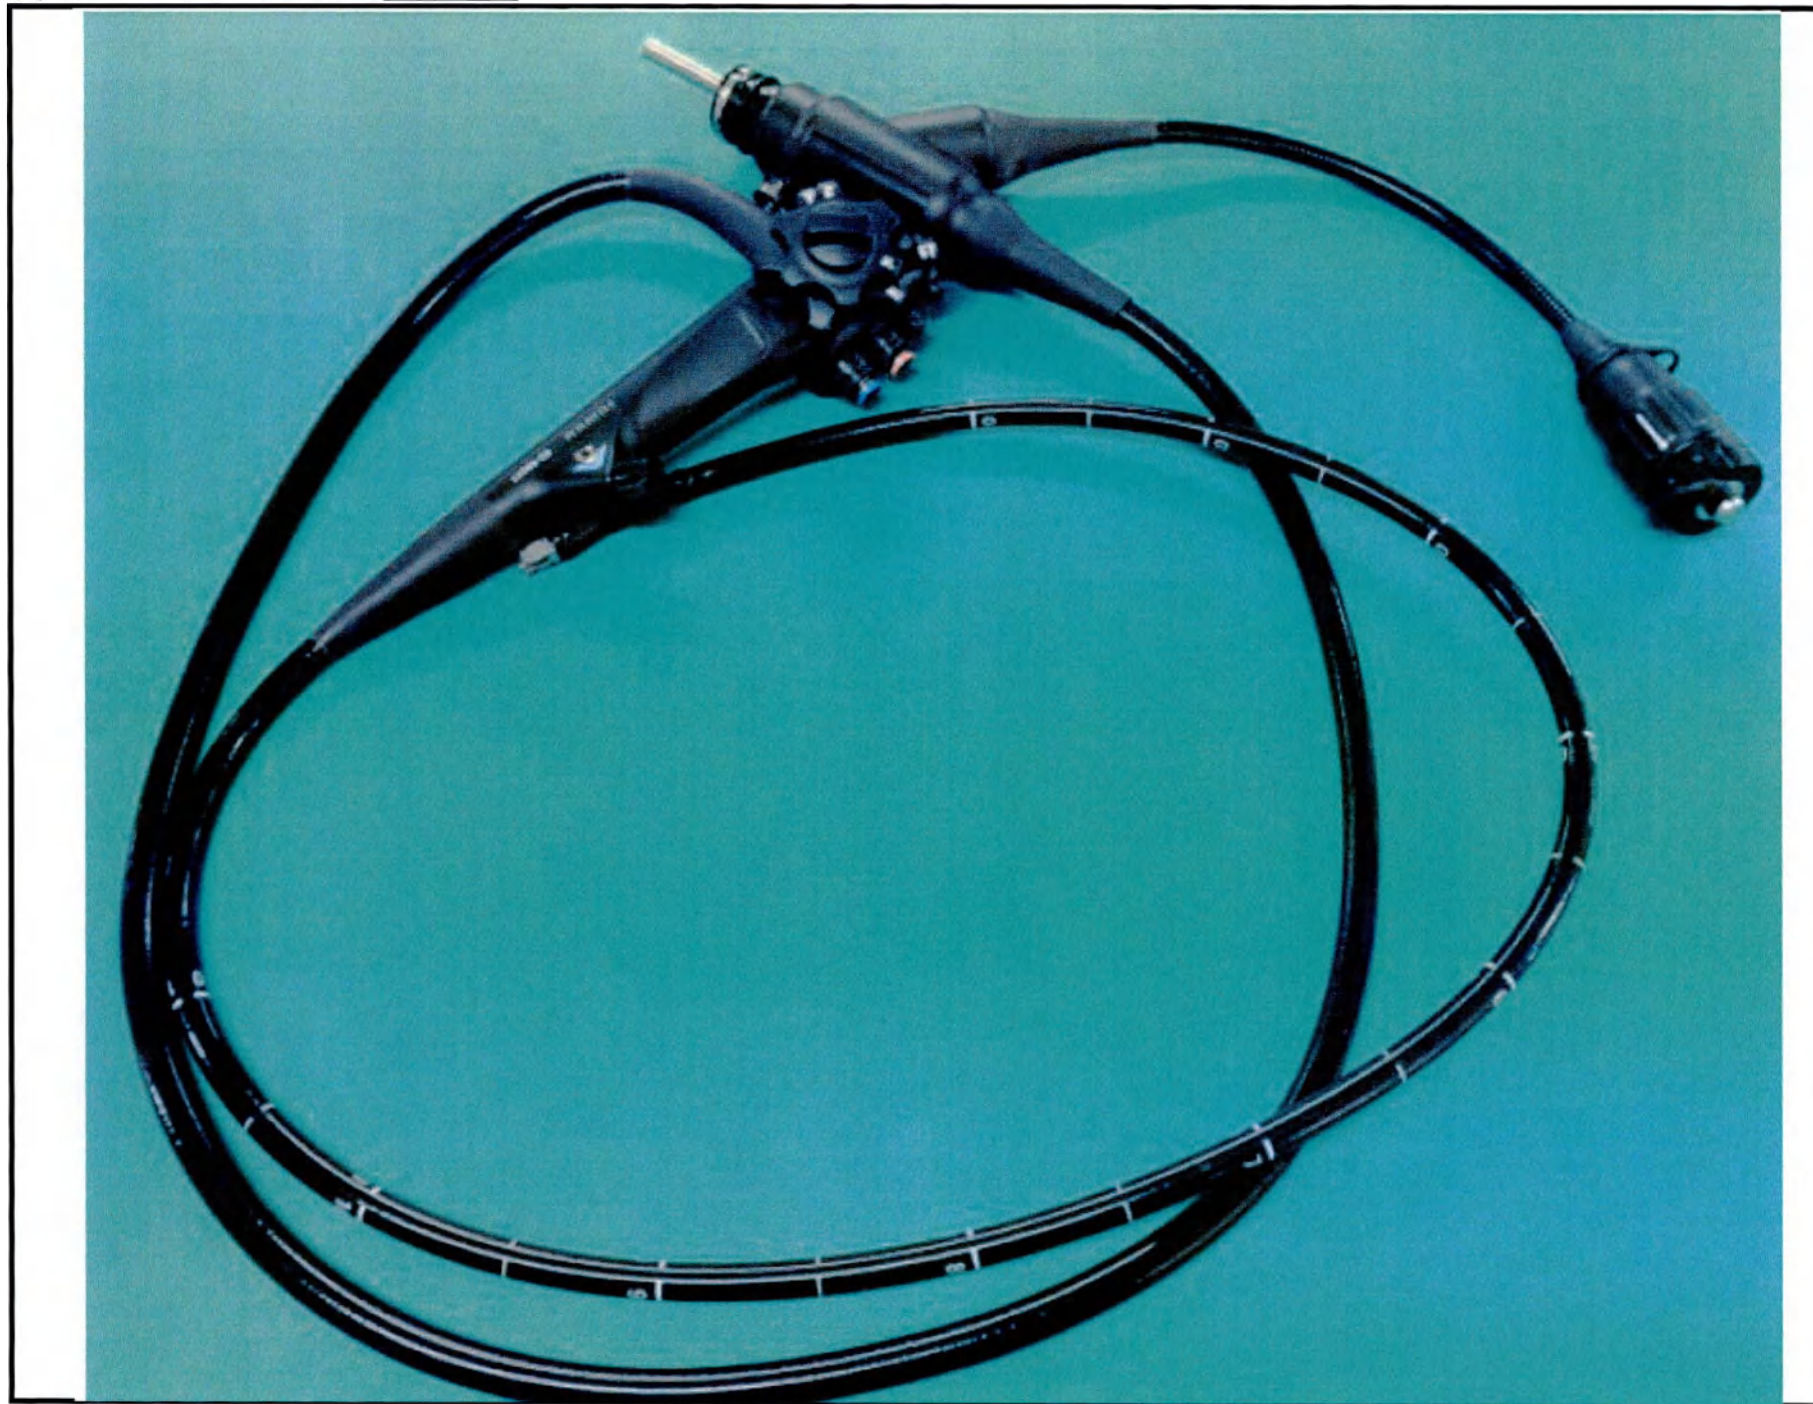

Дуоденоскоп, в исполнении: ED-580XT.



Дуоденоскоп, в исполнении: ED-580XT.

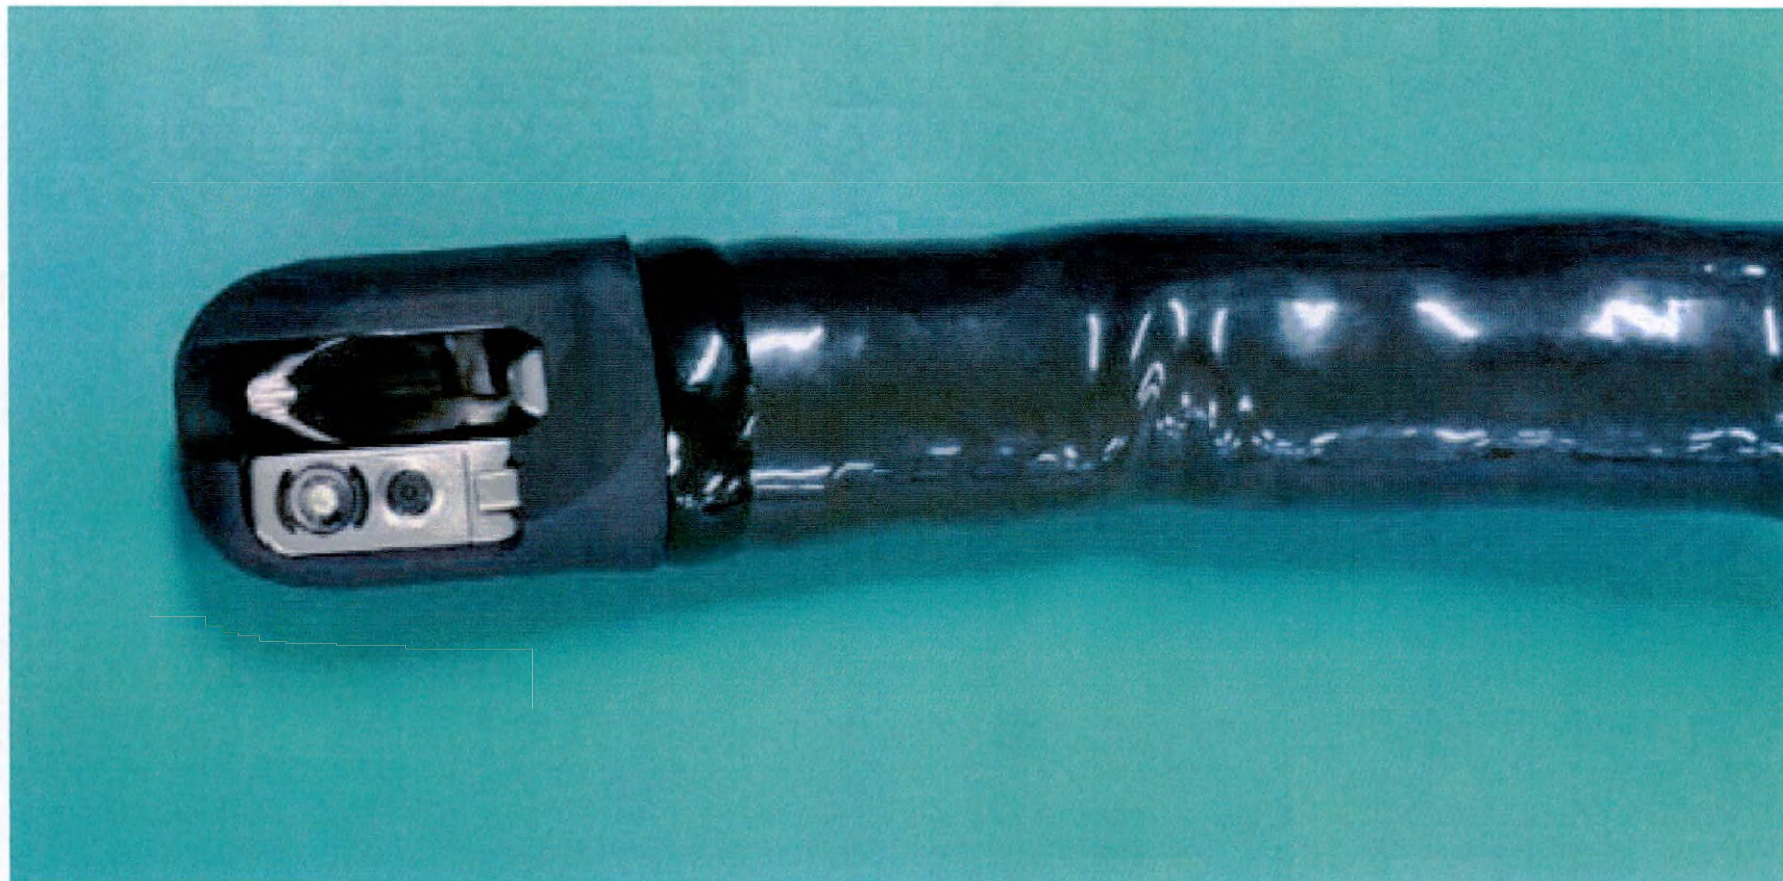

Маркировка на примере—Колоноскоп, в исполнении: EC-530WL3.

**Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного
тракта: Колоноскоп**

Модель: EC-530WL3

Производитель:

ФУДЖИФИЛЬМ

FUJIFILM

Корпорейшн,

Corporation,

Япония

Japan

Страна

происхождения:

Уполномоченный

АО «Р-Фарм»

представитель

123154, Москва,

производителя в РФ:

ул. Берзарина, д. 19, корп. 1,

тел. 8-495-956-79-37


факс: 8-495-956-79-38

e-mail: info@rpharm.ru

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.


Колоноскоп, в исполнении: EC-530WL3.

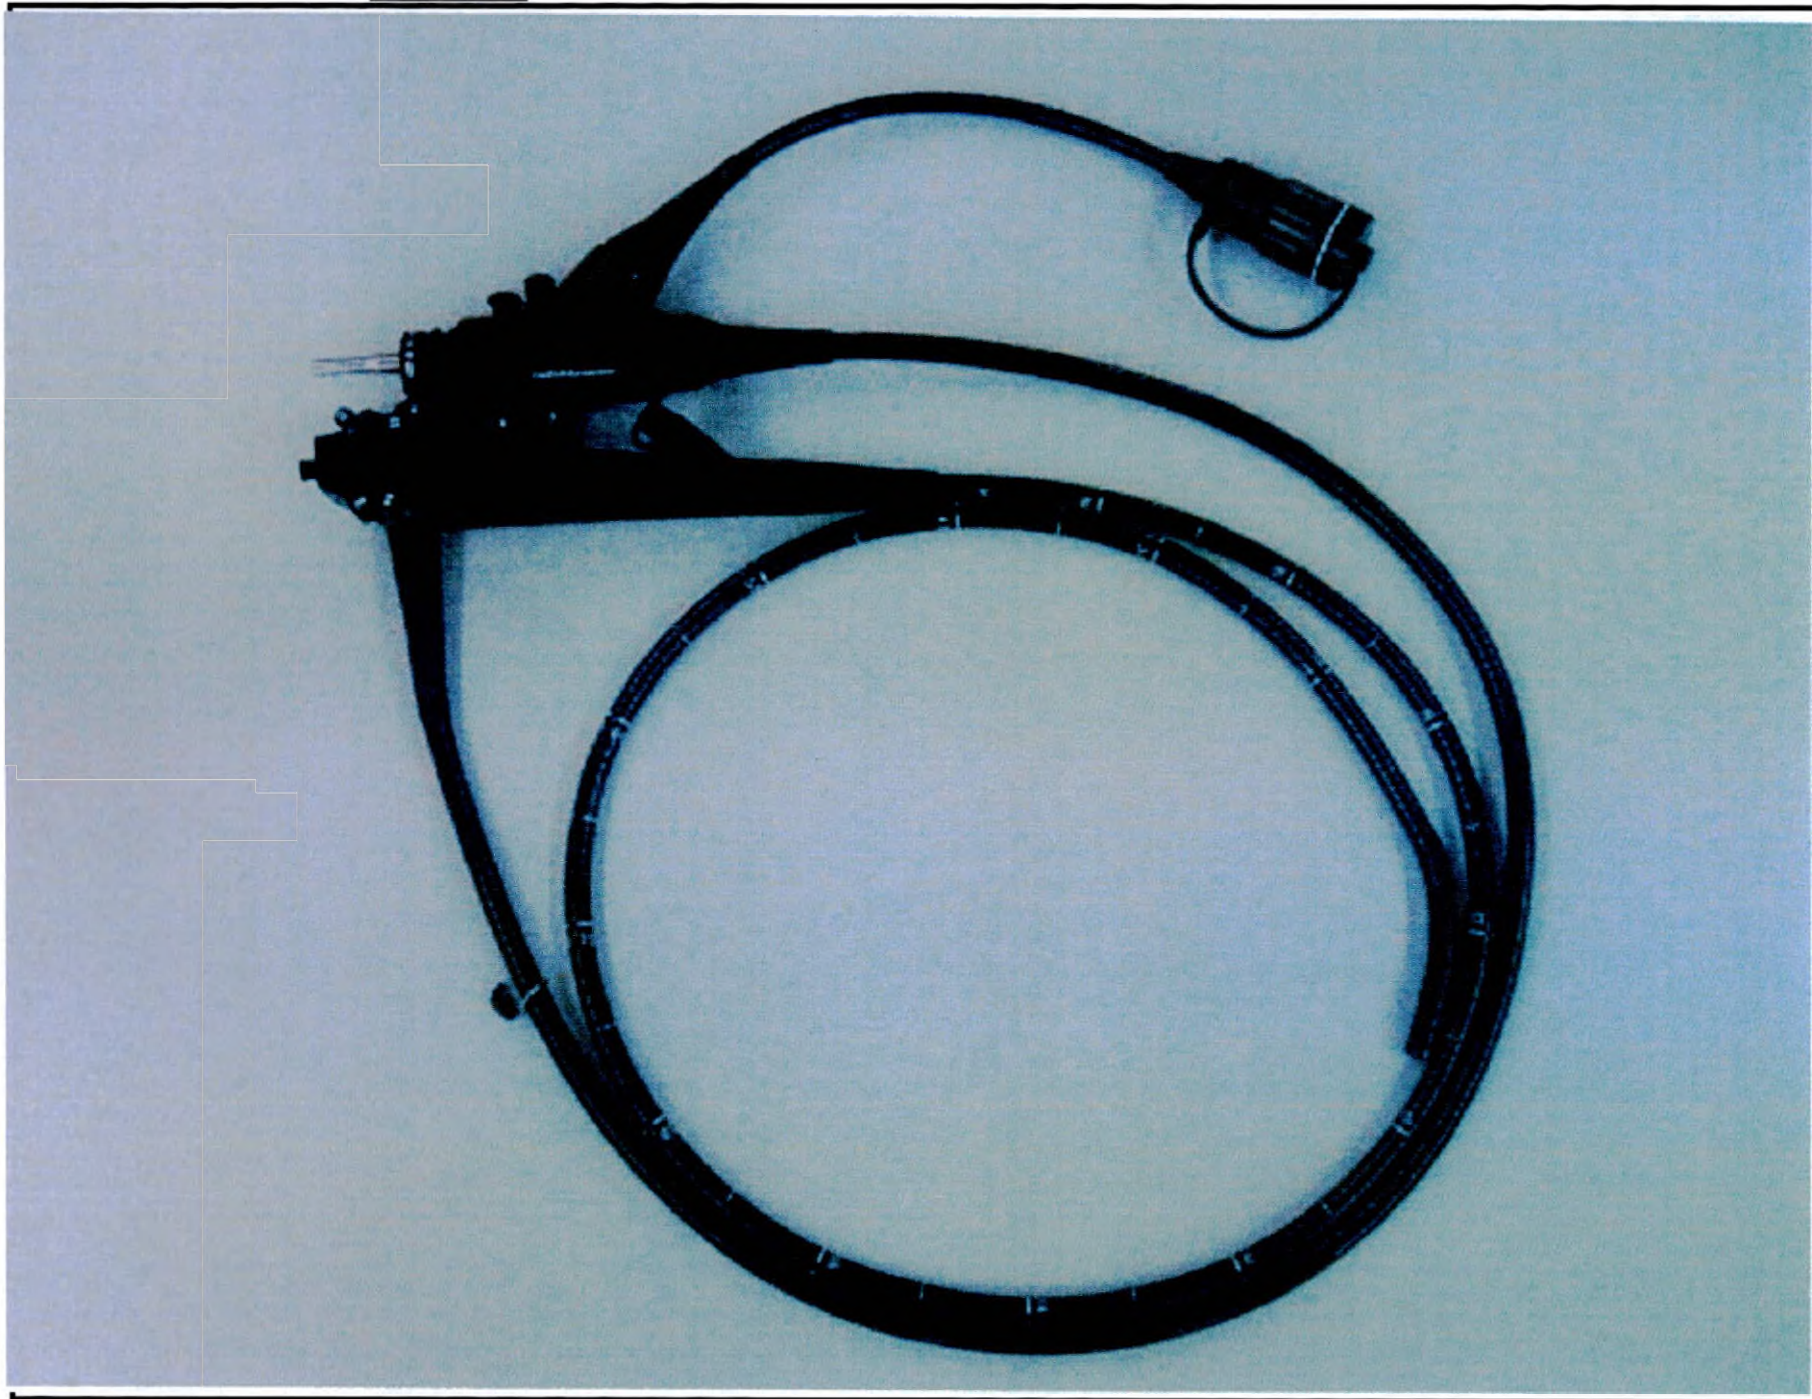


Колоноскоп, в исполнении: EC-530WL3.



Колоноскоп, в исполнении: EC-530WL3.

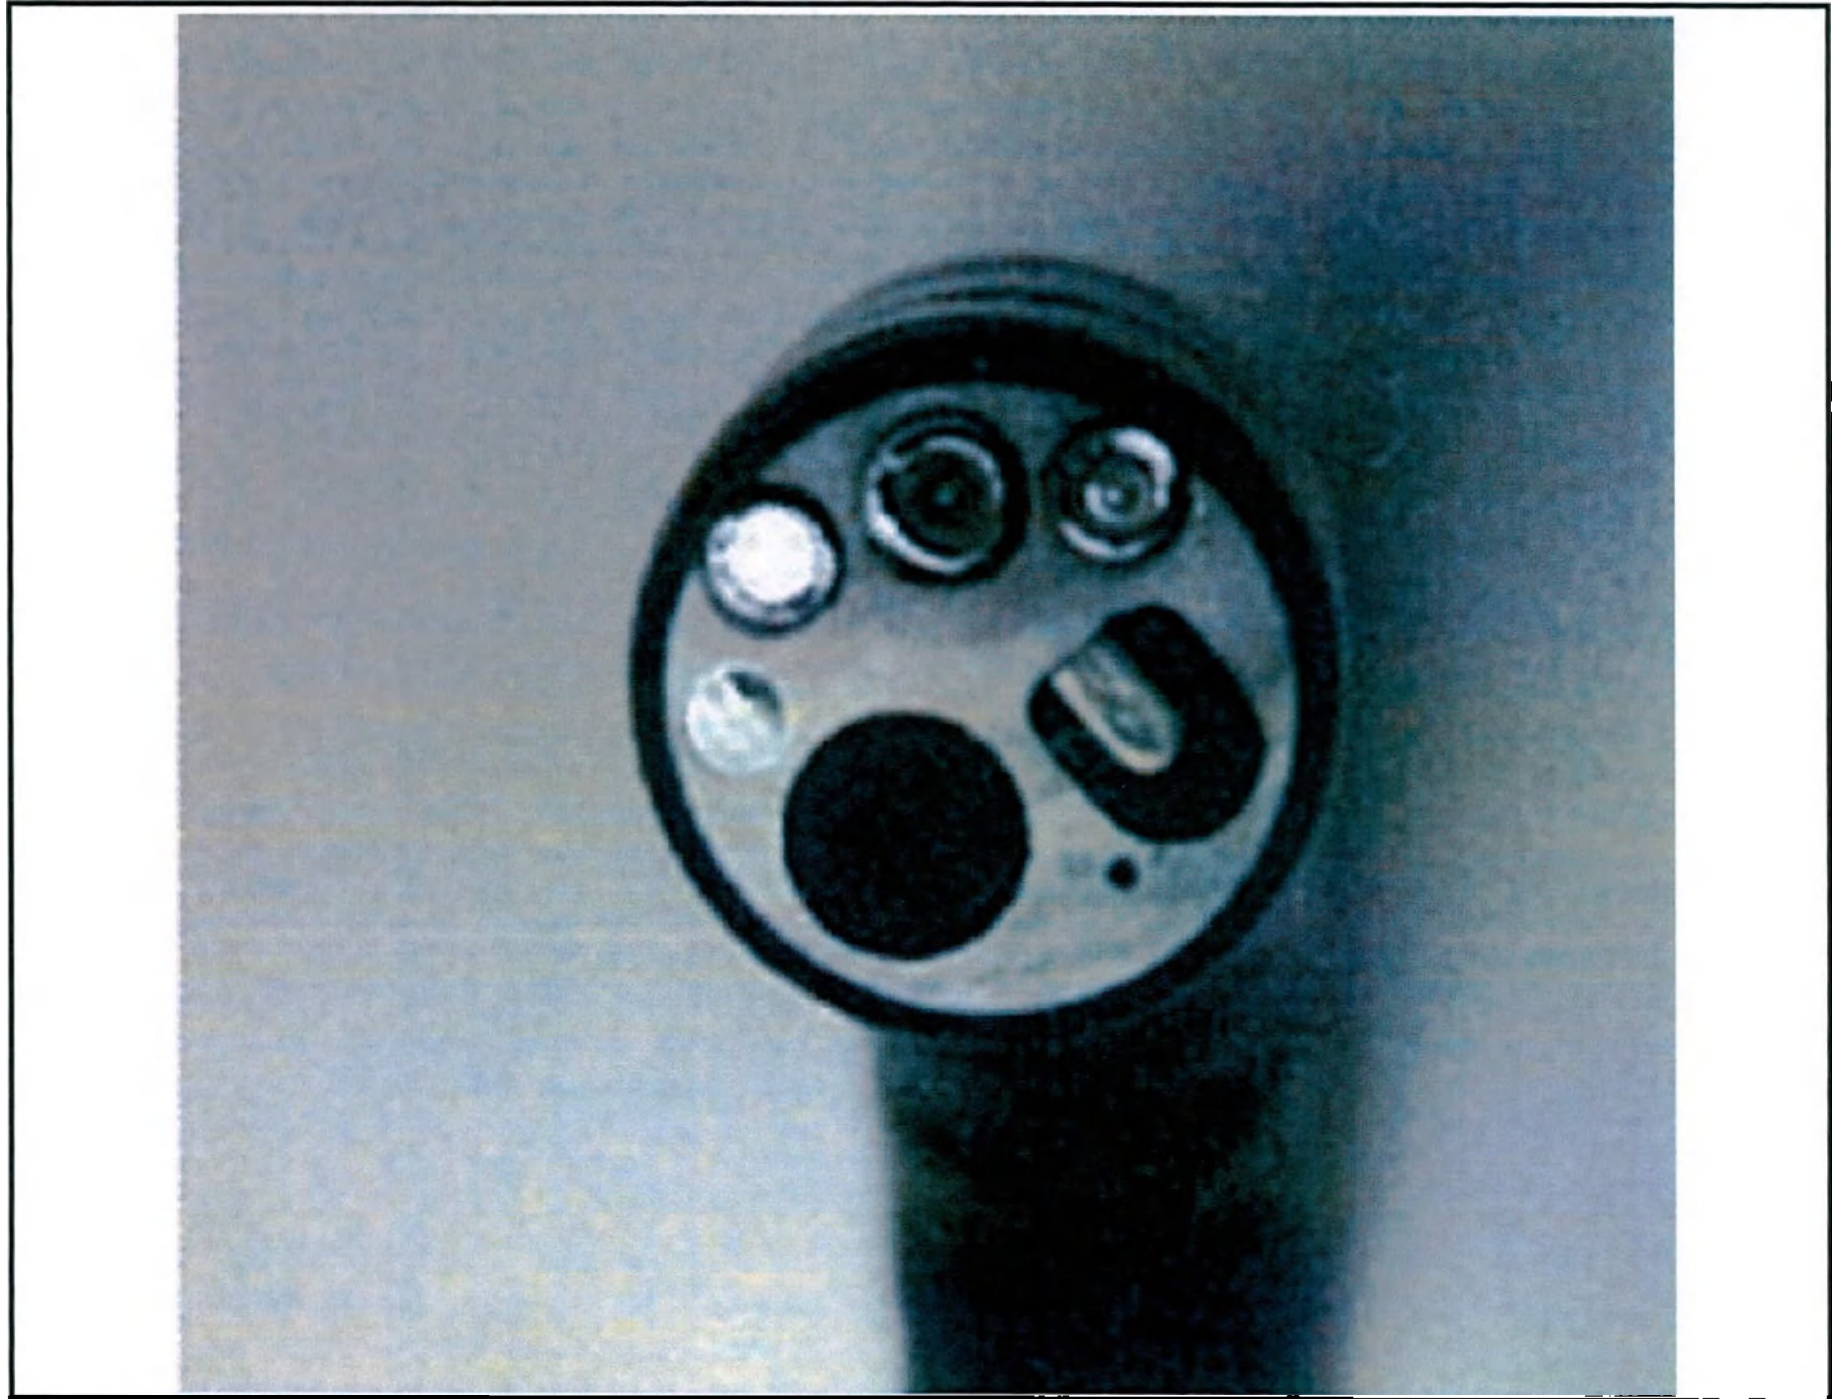

Колоноскоп, в исполнении: EC-720R/L.

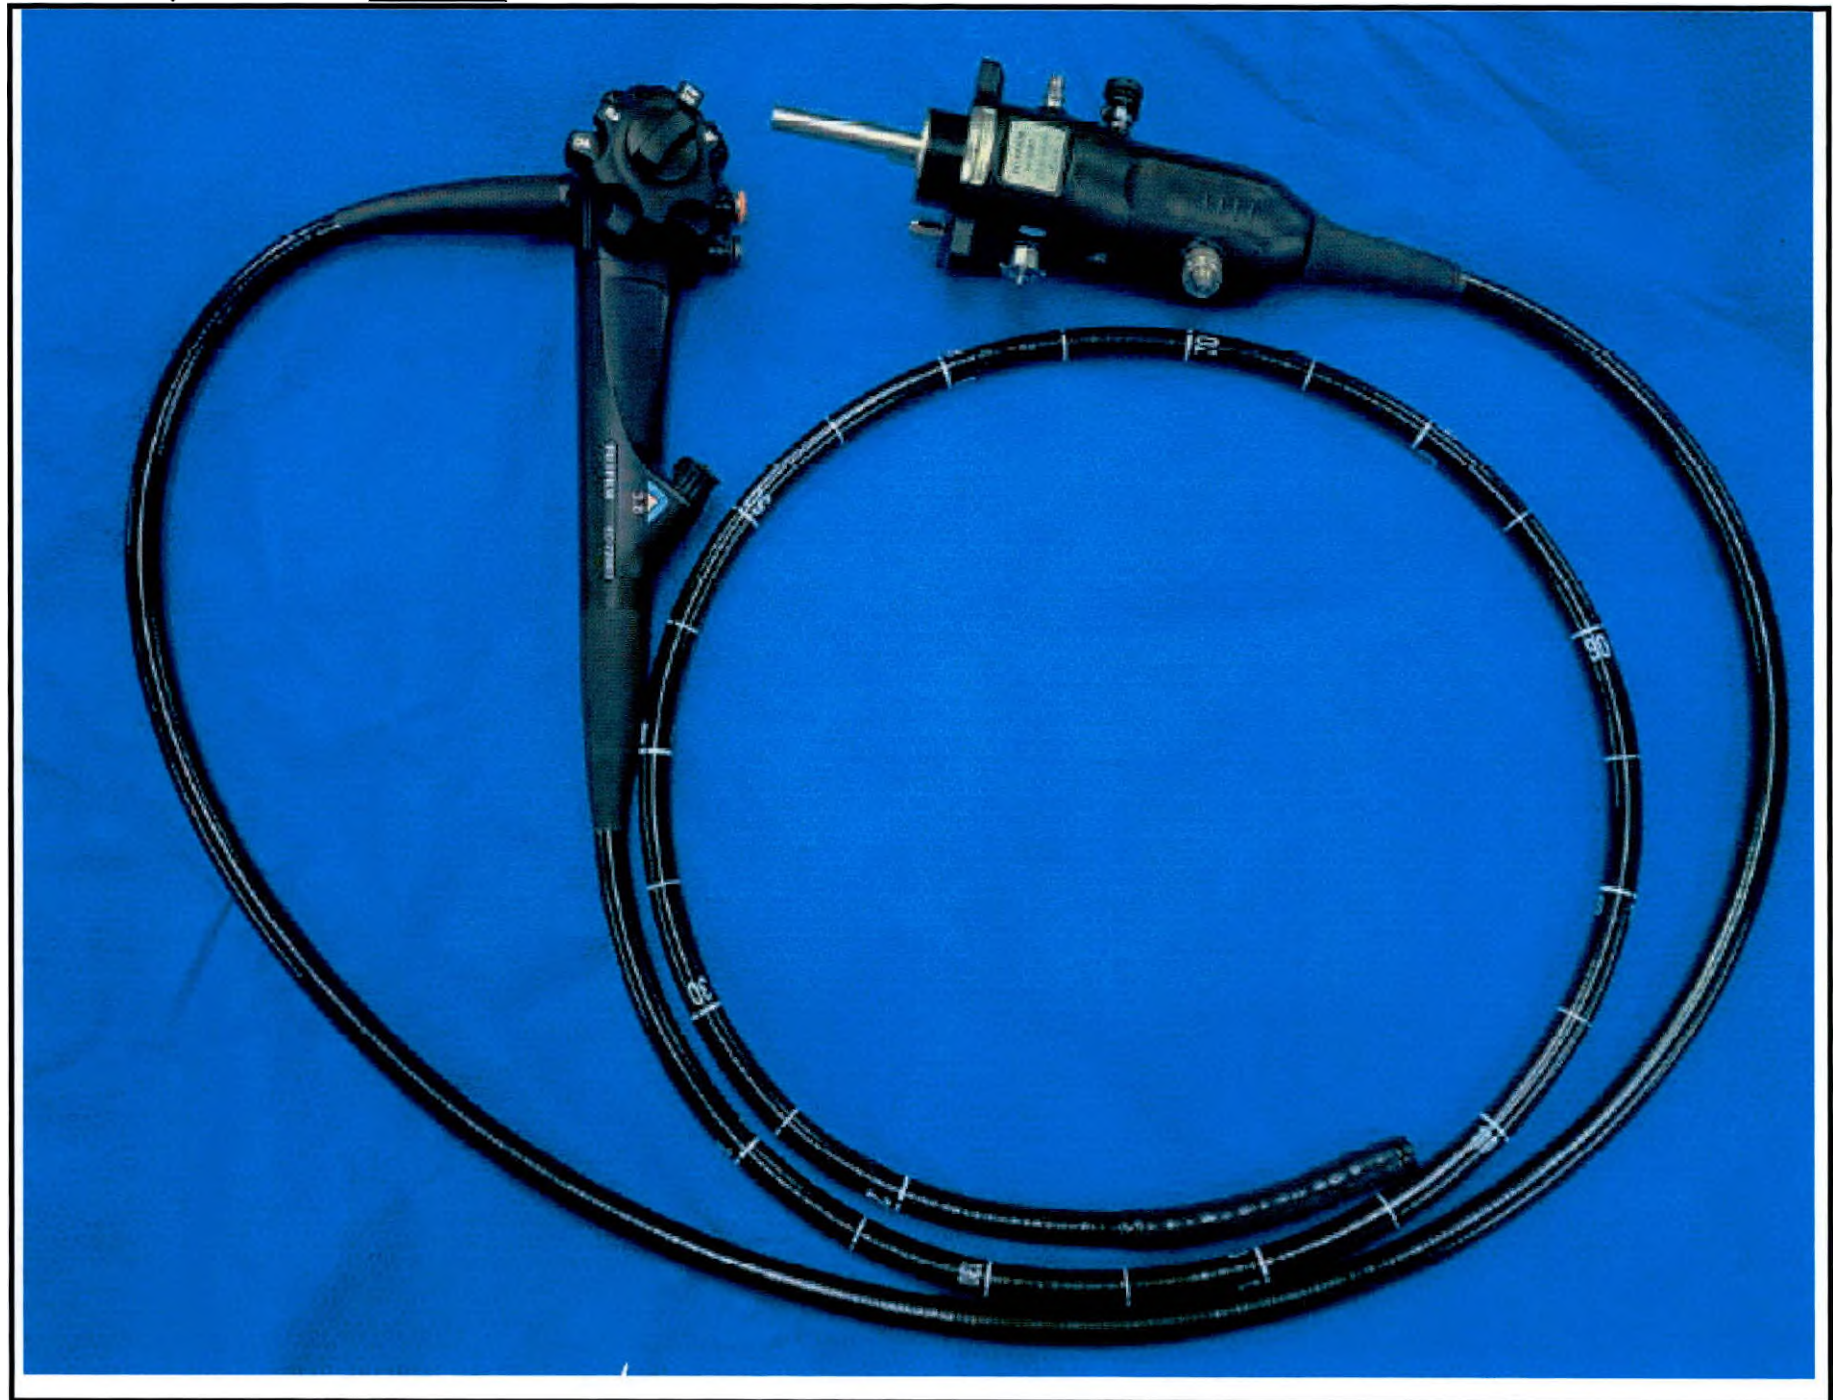


Колоноскоп, в исполнении: EC-720R/L.



Колоноскоп, в исполнении: EC-720R/L.




Колоноскоп, в исполнении: EC-720R/L.

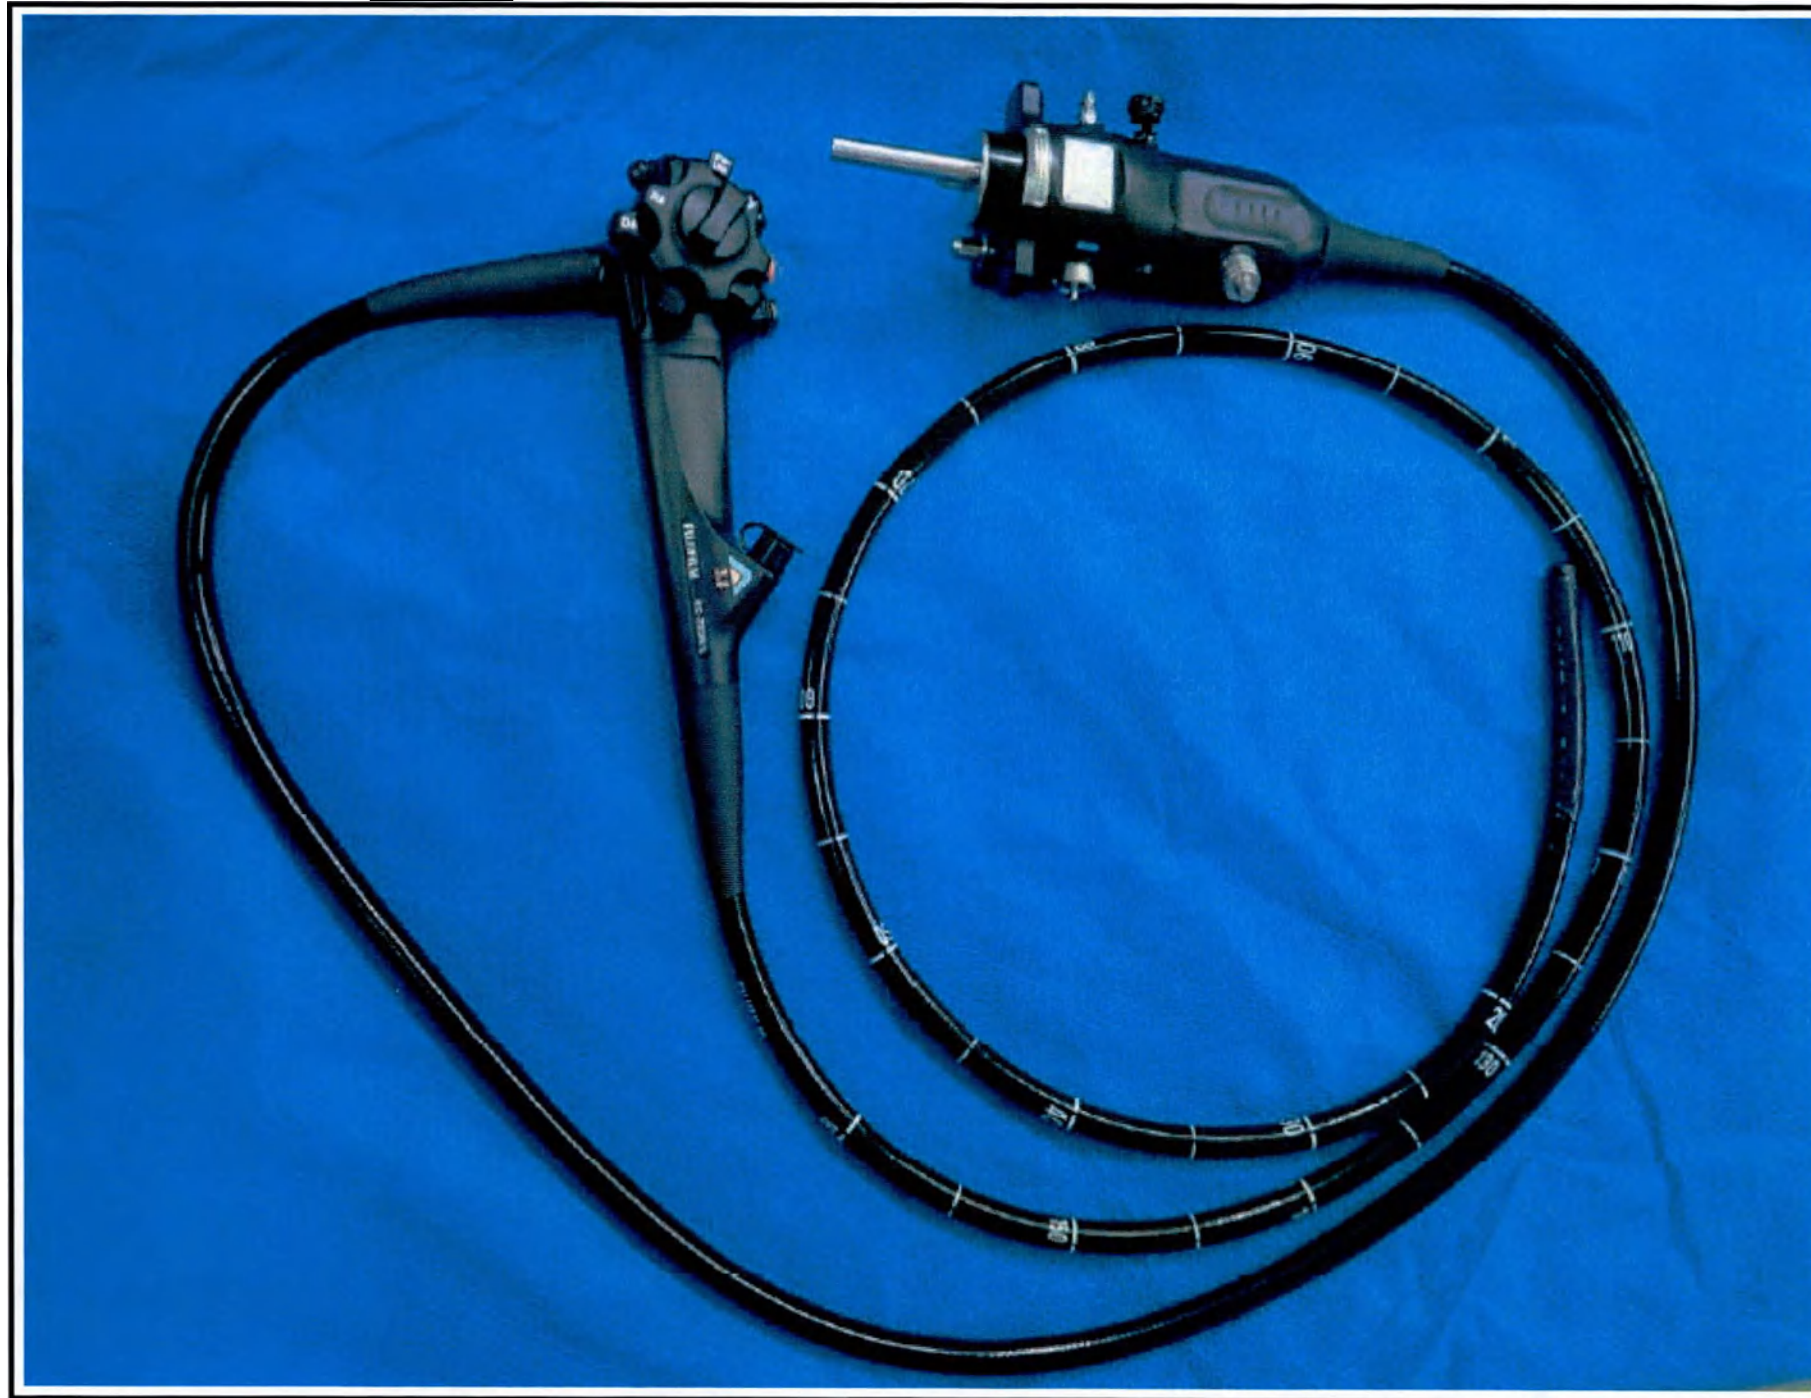


Колоноскоп, в исполнении: EC-720R/L.



Колоноскоп, в исполнении: EC-720R/L.

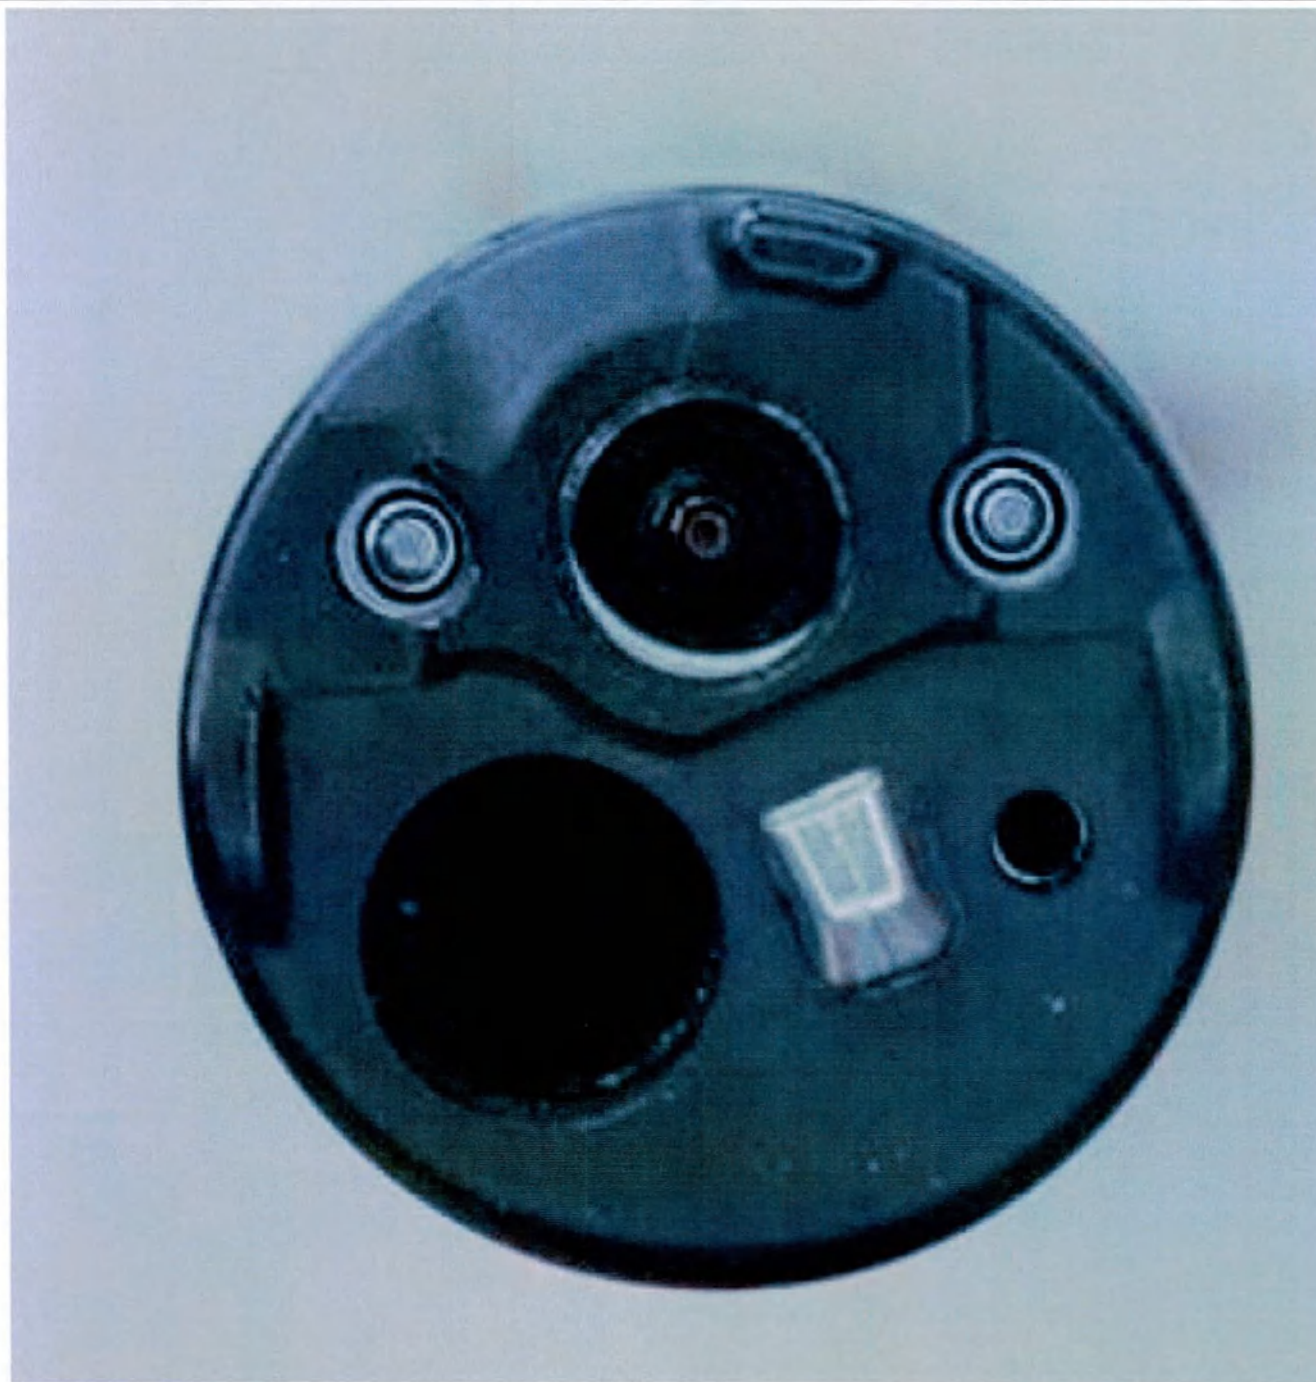

Колоноскоп, в исполнении: EC-720R/M.

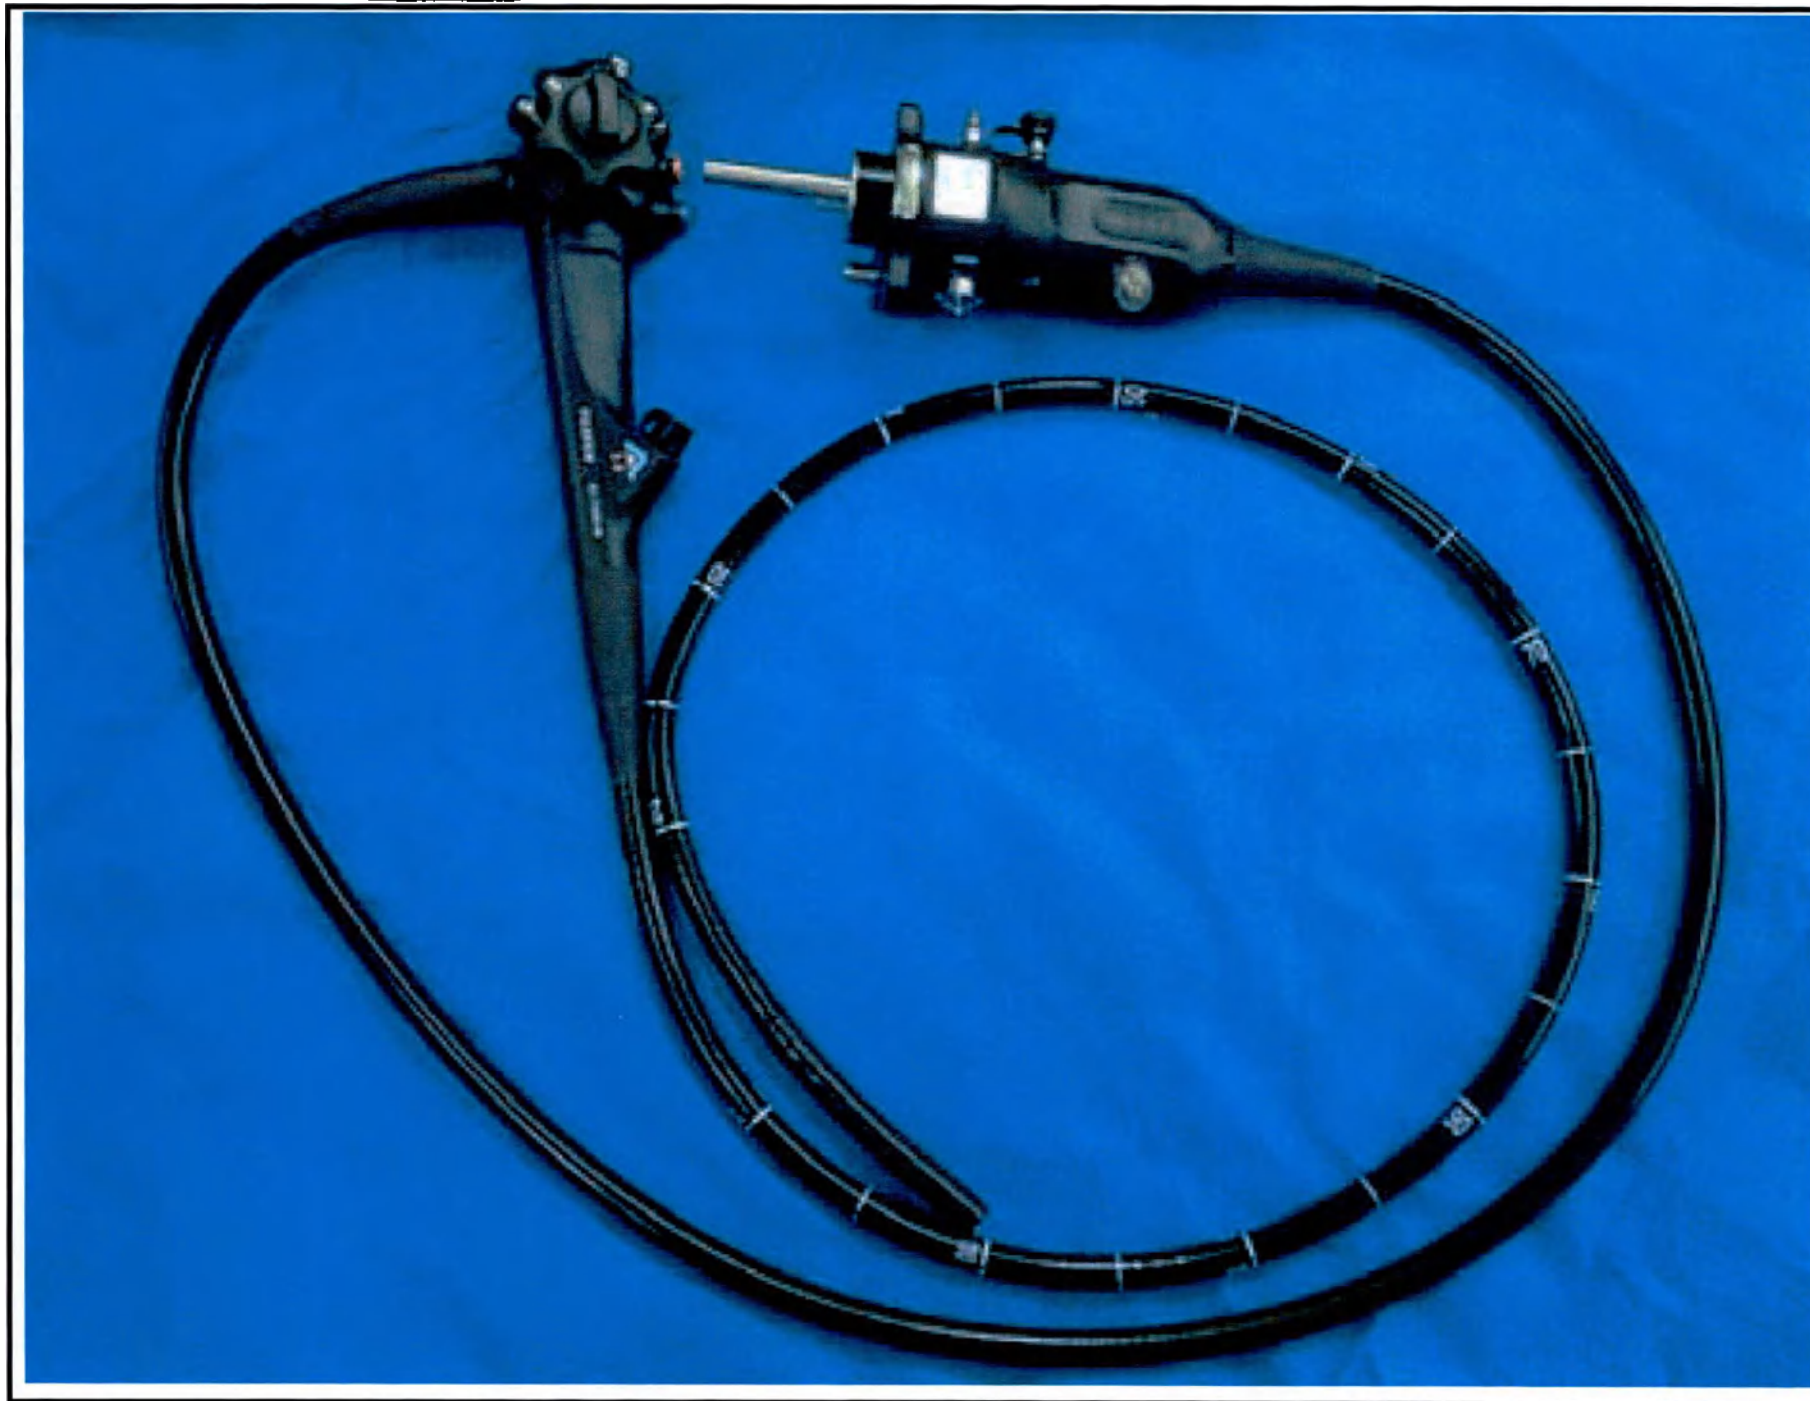


Колоноскоп, в исполнении: EC-720R/M.



Колоноскоп, в исполнении: **EC-720R/M**.



Колоноскоп, в исполнении: **EC-760P-V/L**.

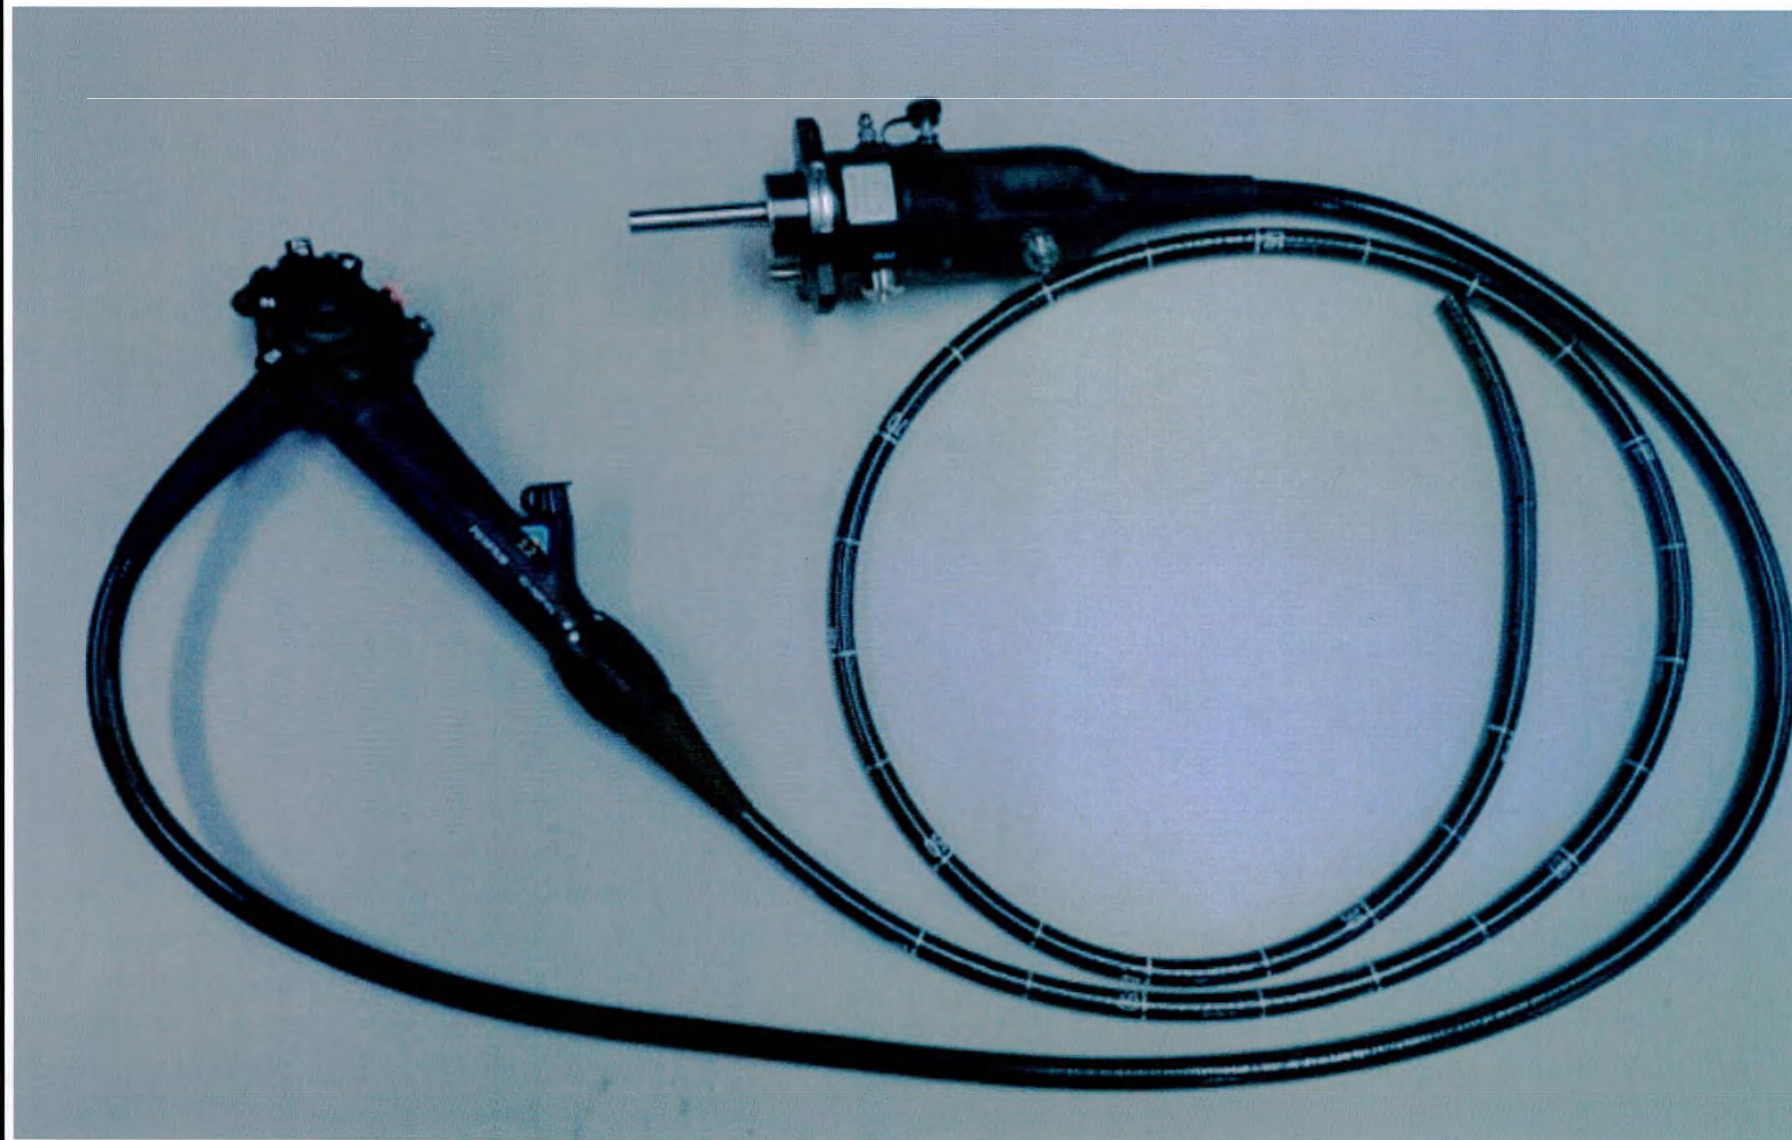


Колоноскоп, в исполнении: EC-760P-V/L.



Колоноскоп, в исполнении: EC-760P-V/L.



Колоноскоп, в исполнении: EC-760Z-V/L.

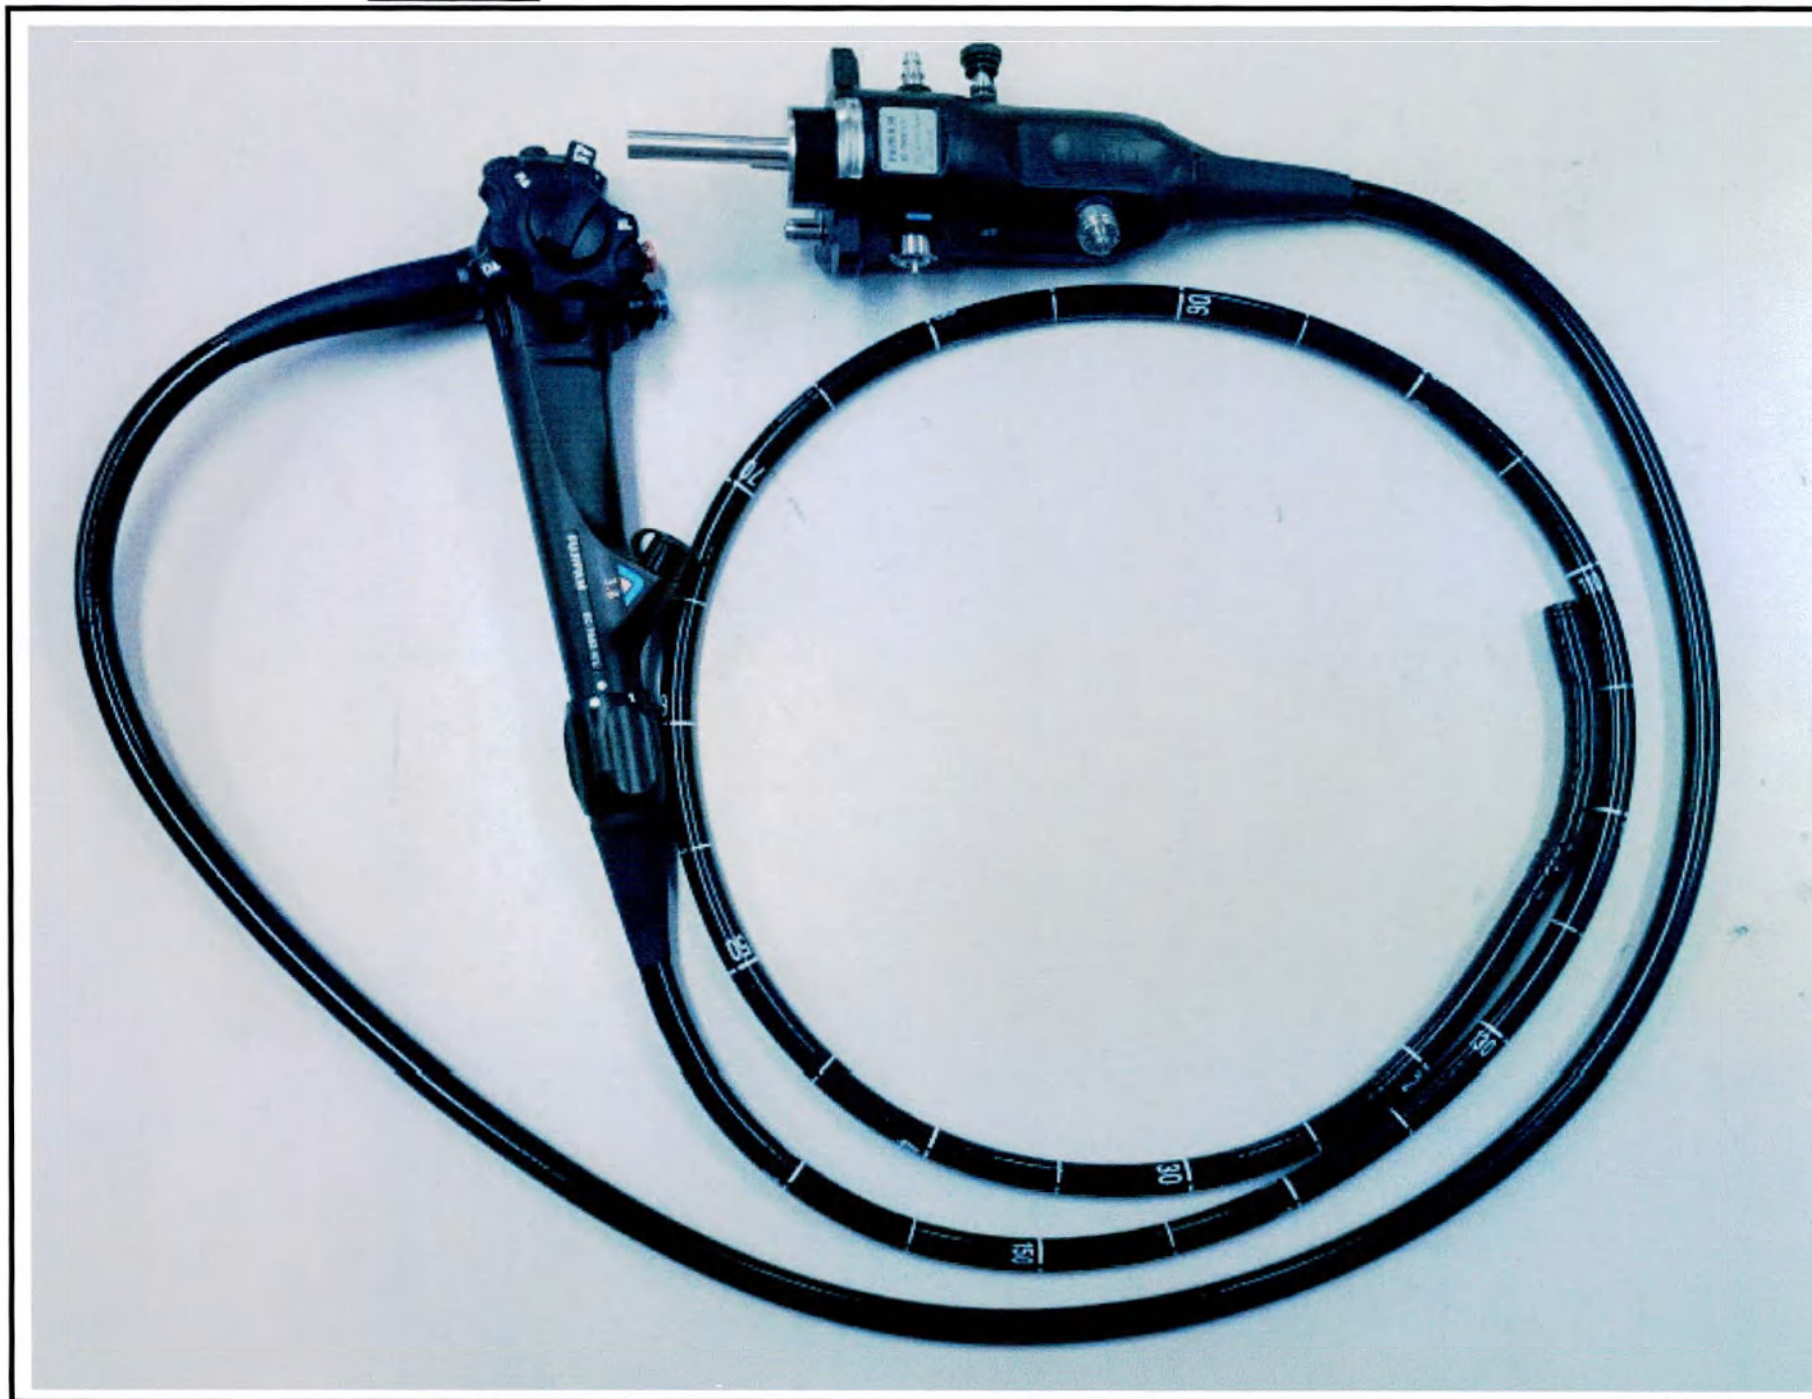


Колоноскоп, в исполнении: EC-760Z-V/L.




Колоноскоп, в исполнении: EC-760Z-V/L.



Колоноскоп, в исполнении: **EC-760P-V/M**.

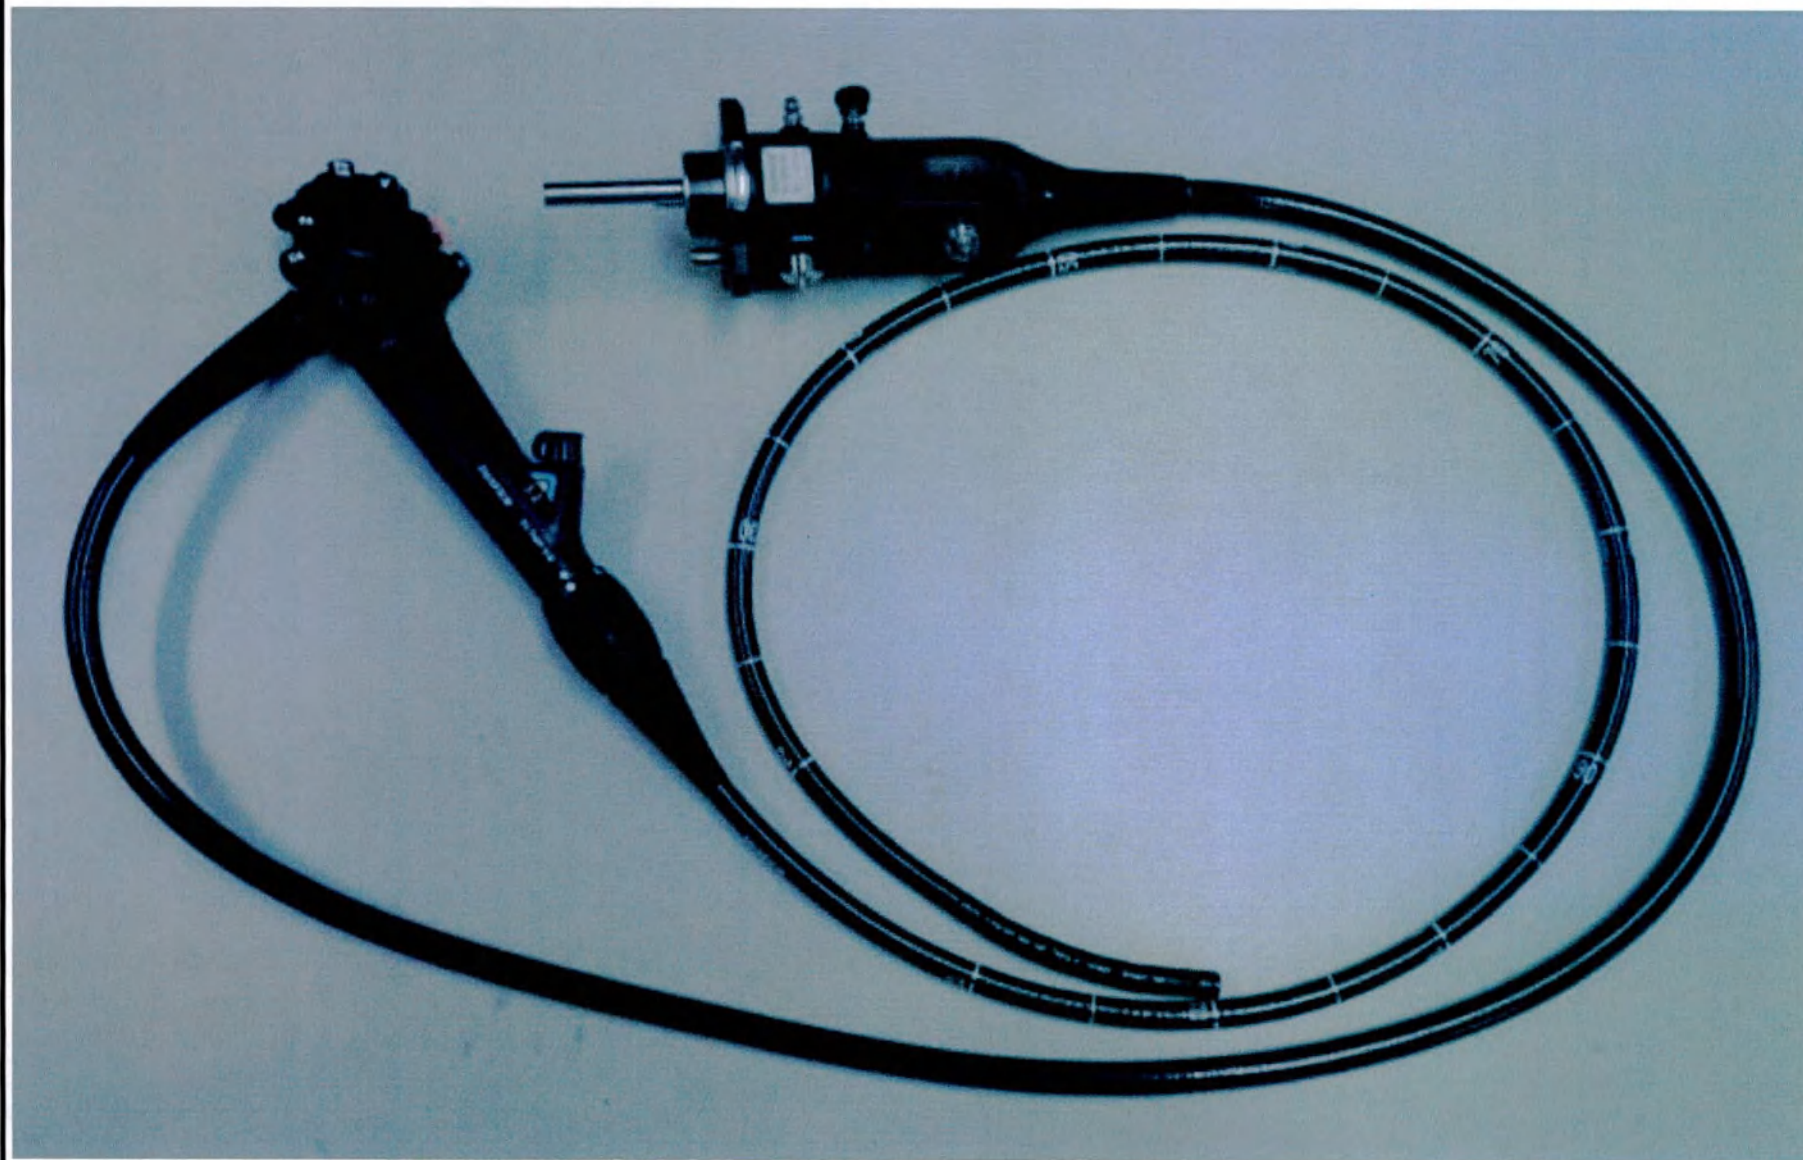

Колоноскоп, в исполнении: EC-760P-V/M.

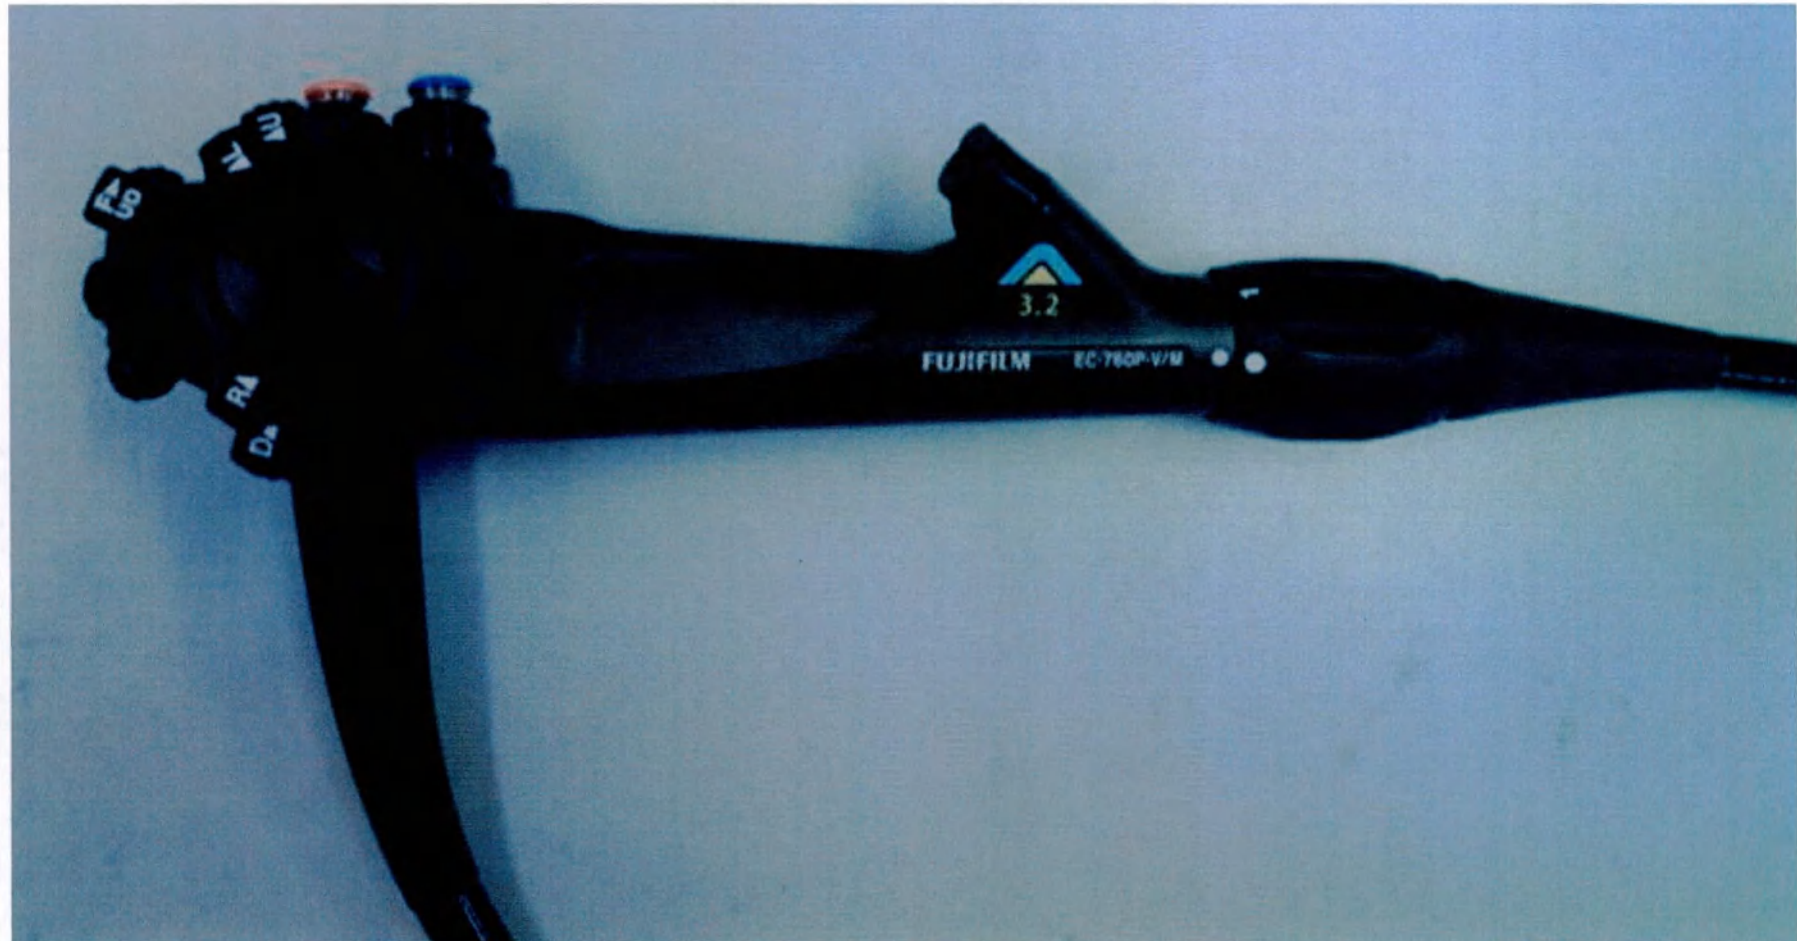


Колоноскоп, в исполнении: **EC-760P-V/M.**



A black and white photograph of a medical device, likely a catheter or probe. The device consists of a long, flexible, black tube that is coiled into a large loop. At one end of the tube is a control unit or handle, which is black and has several knobs and a small display. The other end of the tube is a long, thin, flexible probe. The entire device is laid out on a light-colored, flat surface.



Колоноскоп, в исполнении: ЕС-760Z-V/M.

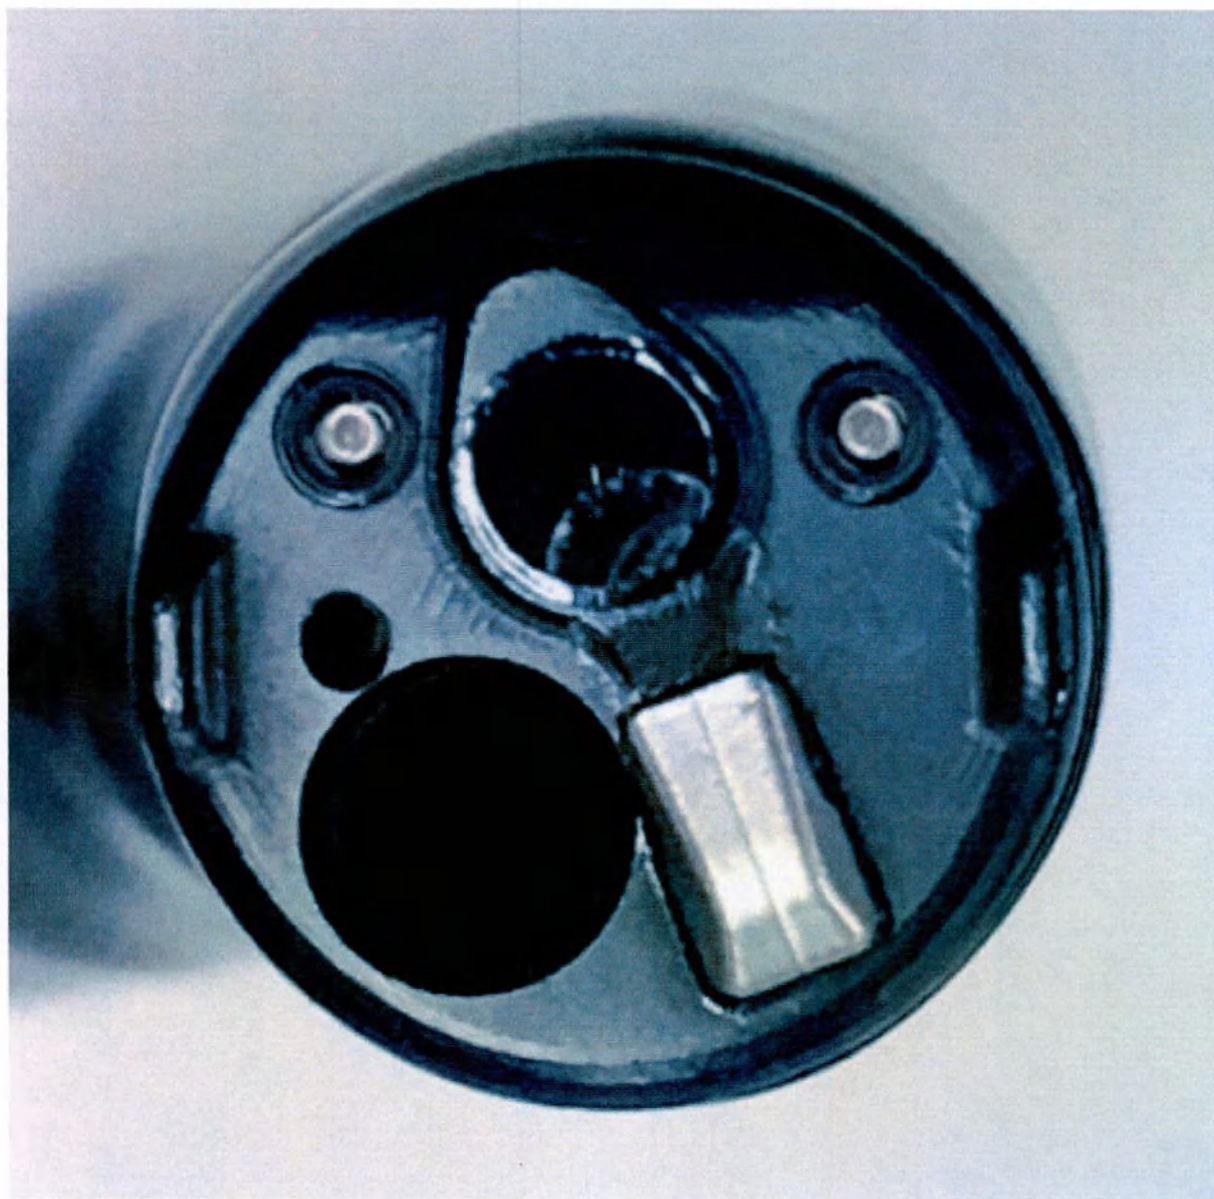

Маркировка на примере— Видеоэндоскоп, в исполнении: EI-740D/S.

**Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного
тракта: Видеоэндоскоп**

Модель: EI-740D/S

Производитель:

ФУДЖИФИЛЬМ

FUJIFILM

Корпорейшн,

Corporation,

Япония

Japan

Страна

происхождения:

Уполномоченный

АО «Р-Фарм»

представитель

123154, Москва,

производителя в РФ:

ул. Берзарины, д. 19, корп. 1,

тел. 8-495-956-79-37


факс: 8-495-956-79-38

e-mail: info@rpharm.ru


Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Видеозондоскоп, в исполнении: EI-580BT.

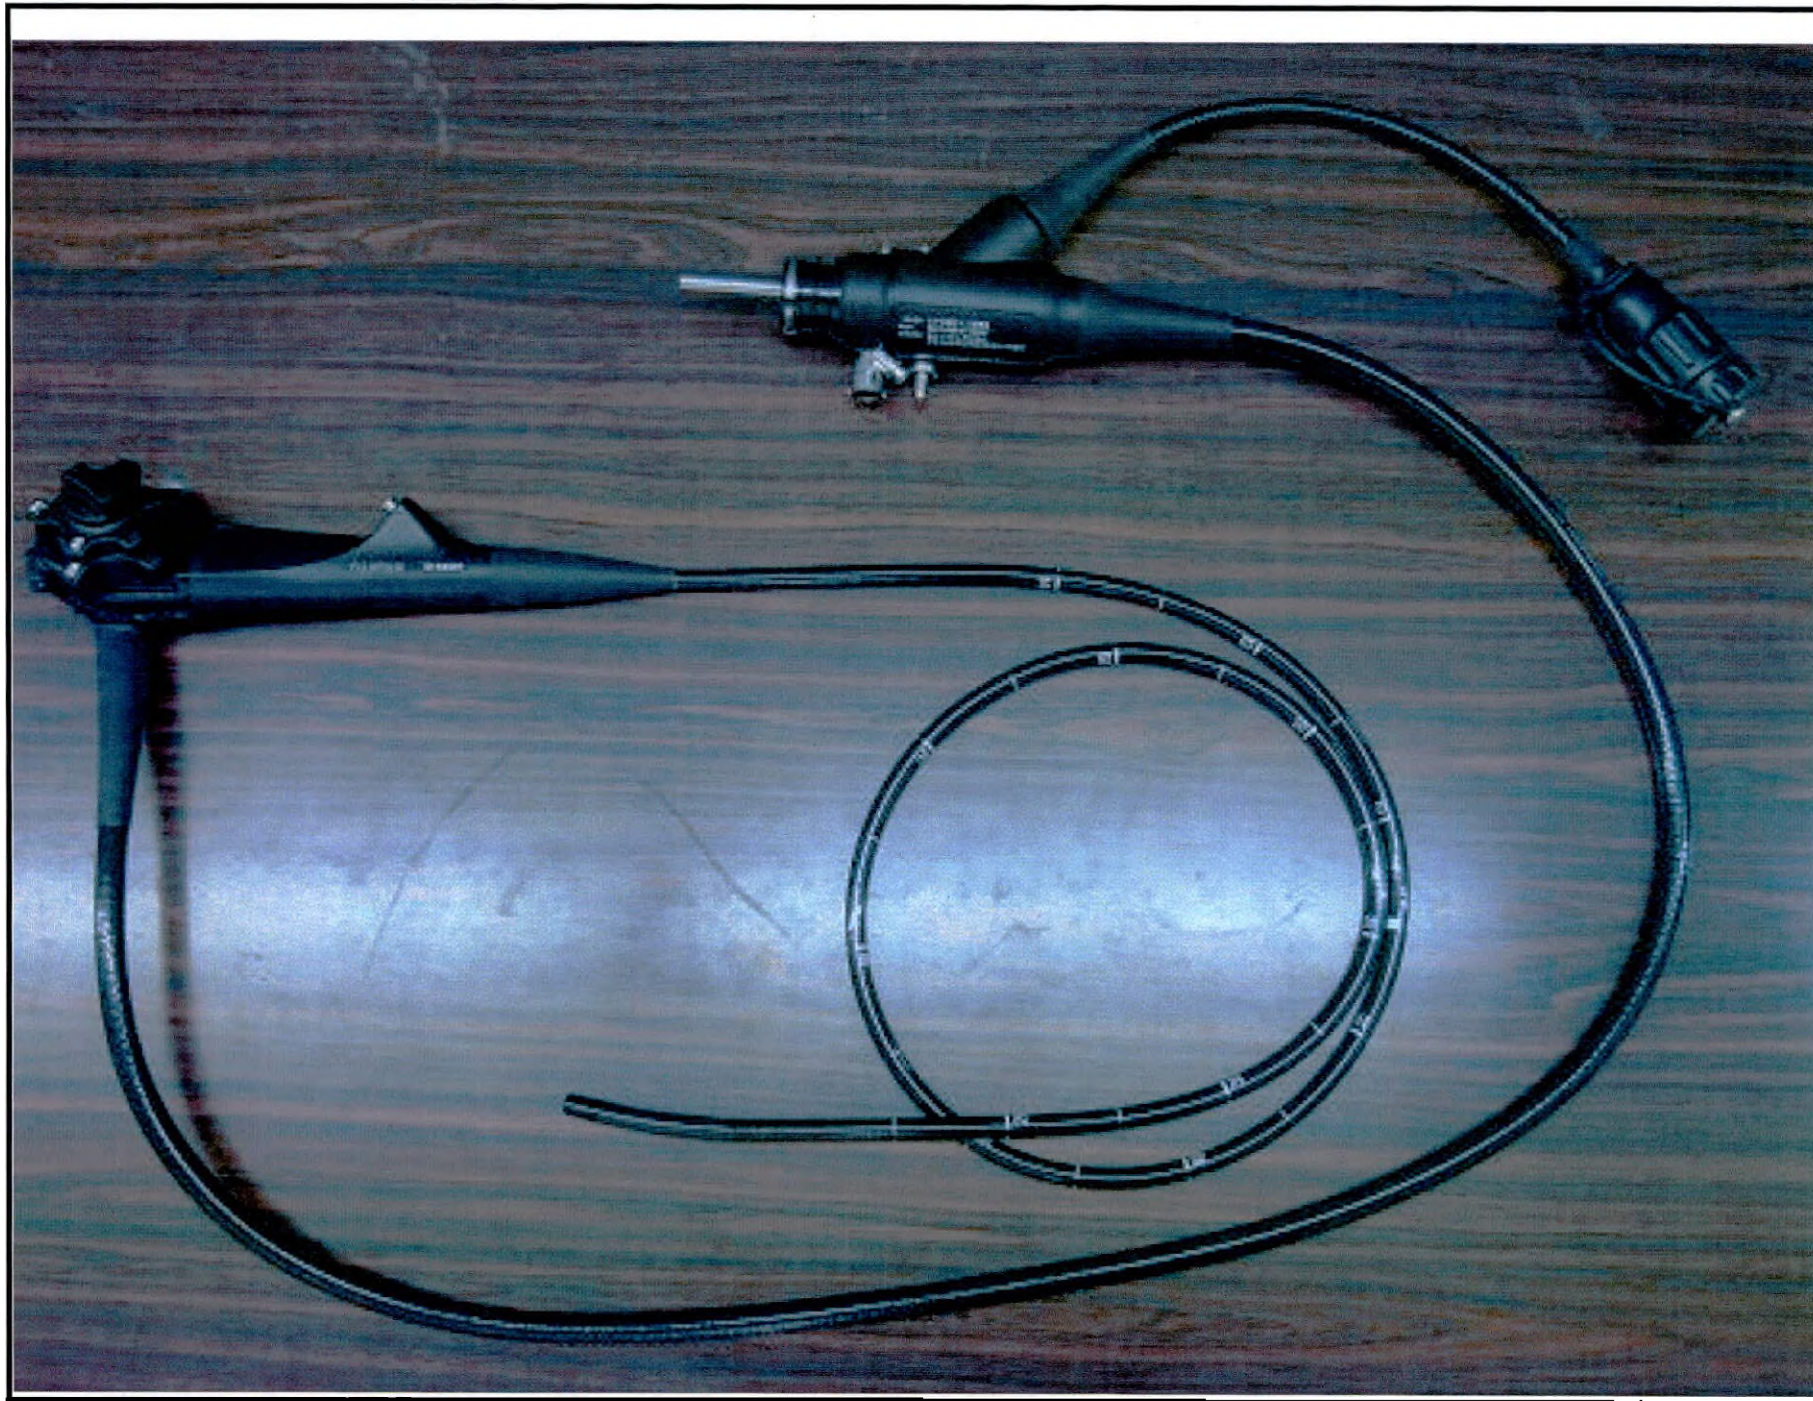


Видеоэндоскоп, в исполнении: EI-580BT.

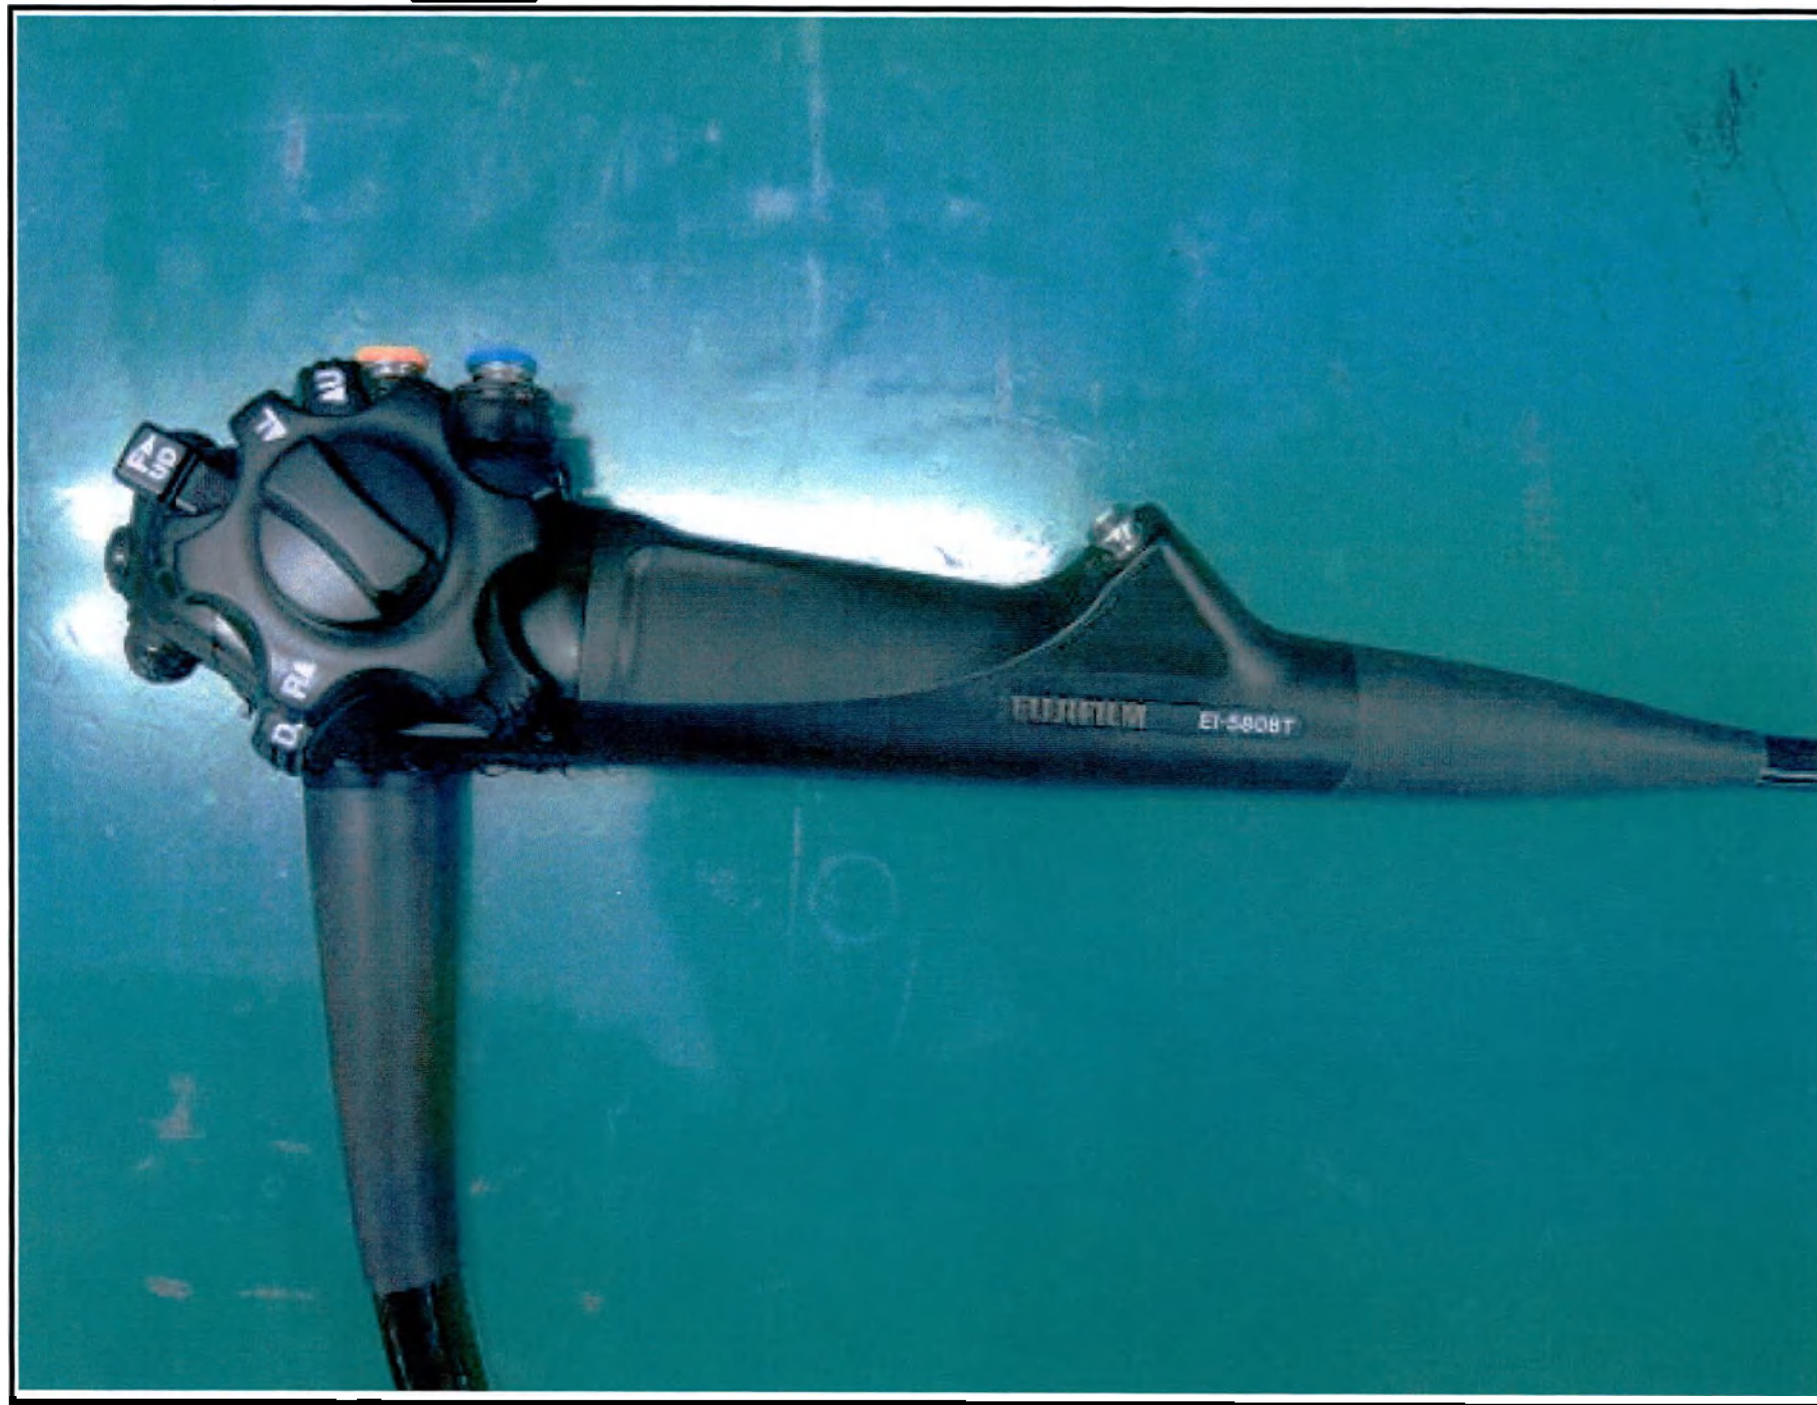

Видеоэндоскоп, в исполнении: EI-580BT.




Видеоэндоскоп, в исполнении: EI-740D/S.

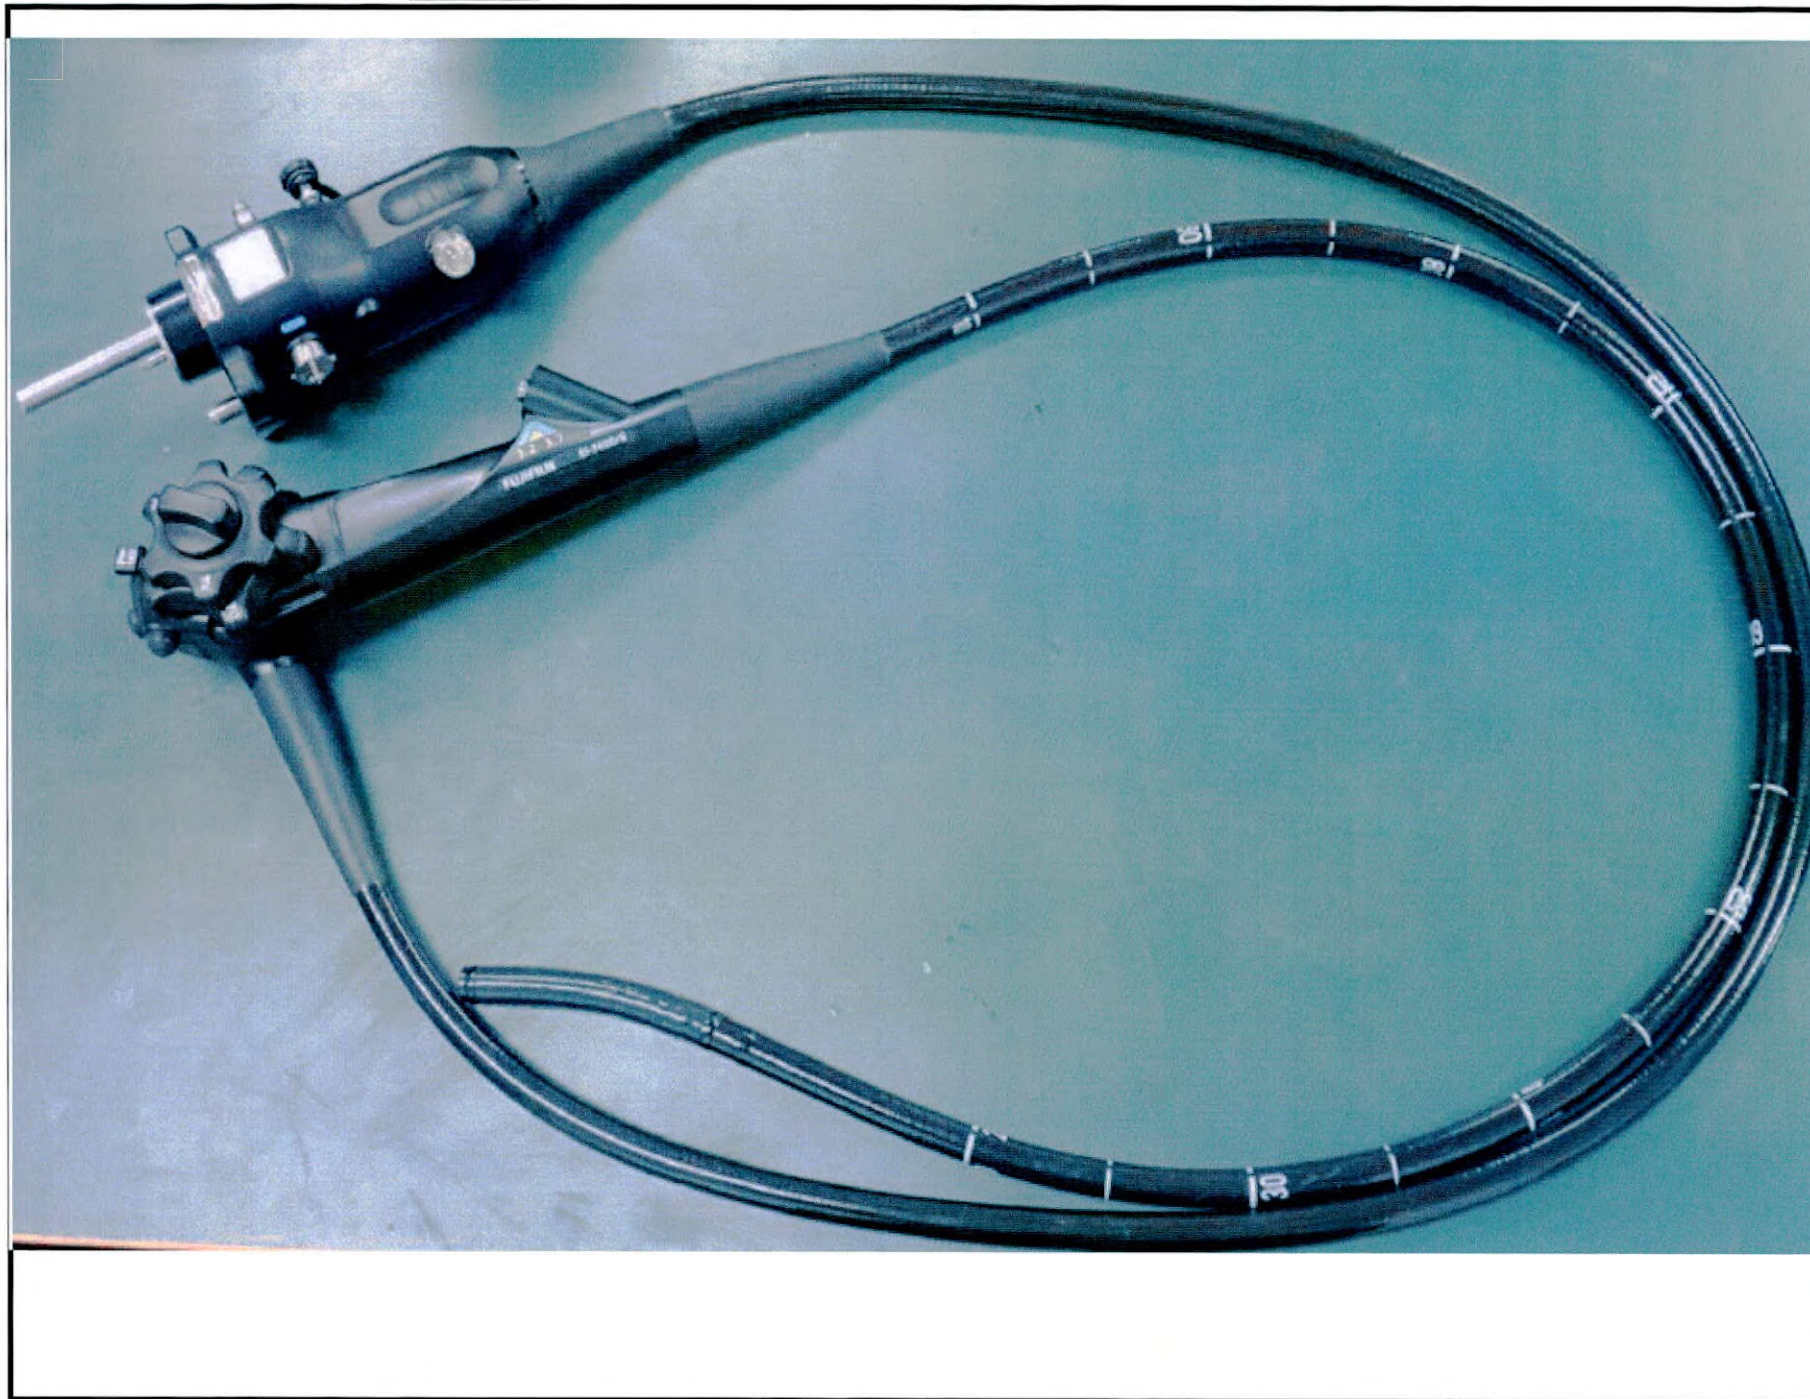

Видеозендоскоп, в исполнении: EI-740D/S.




Видеозендоскоп, в исполнении: **EI-740D/S.**

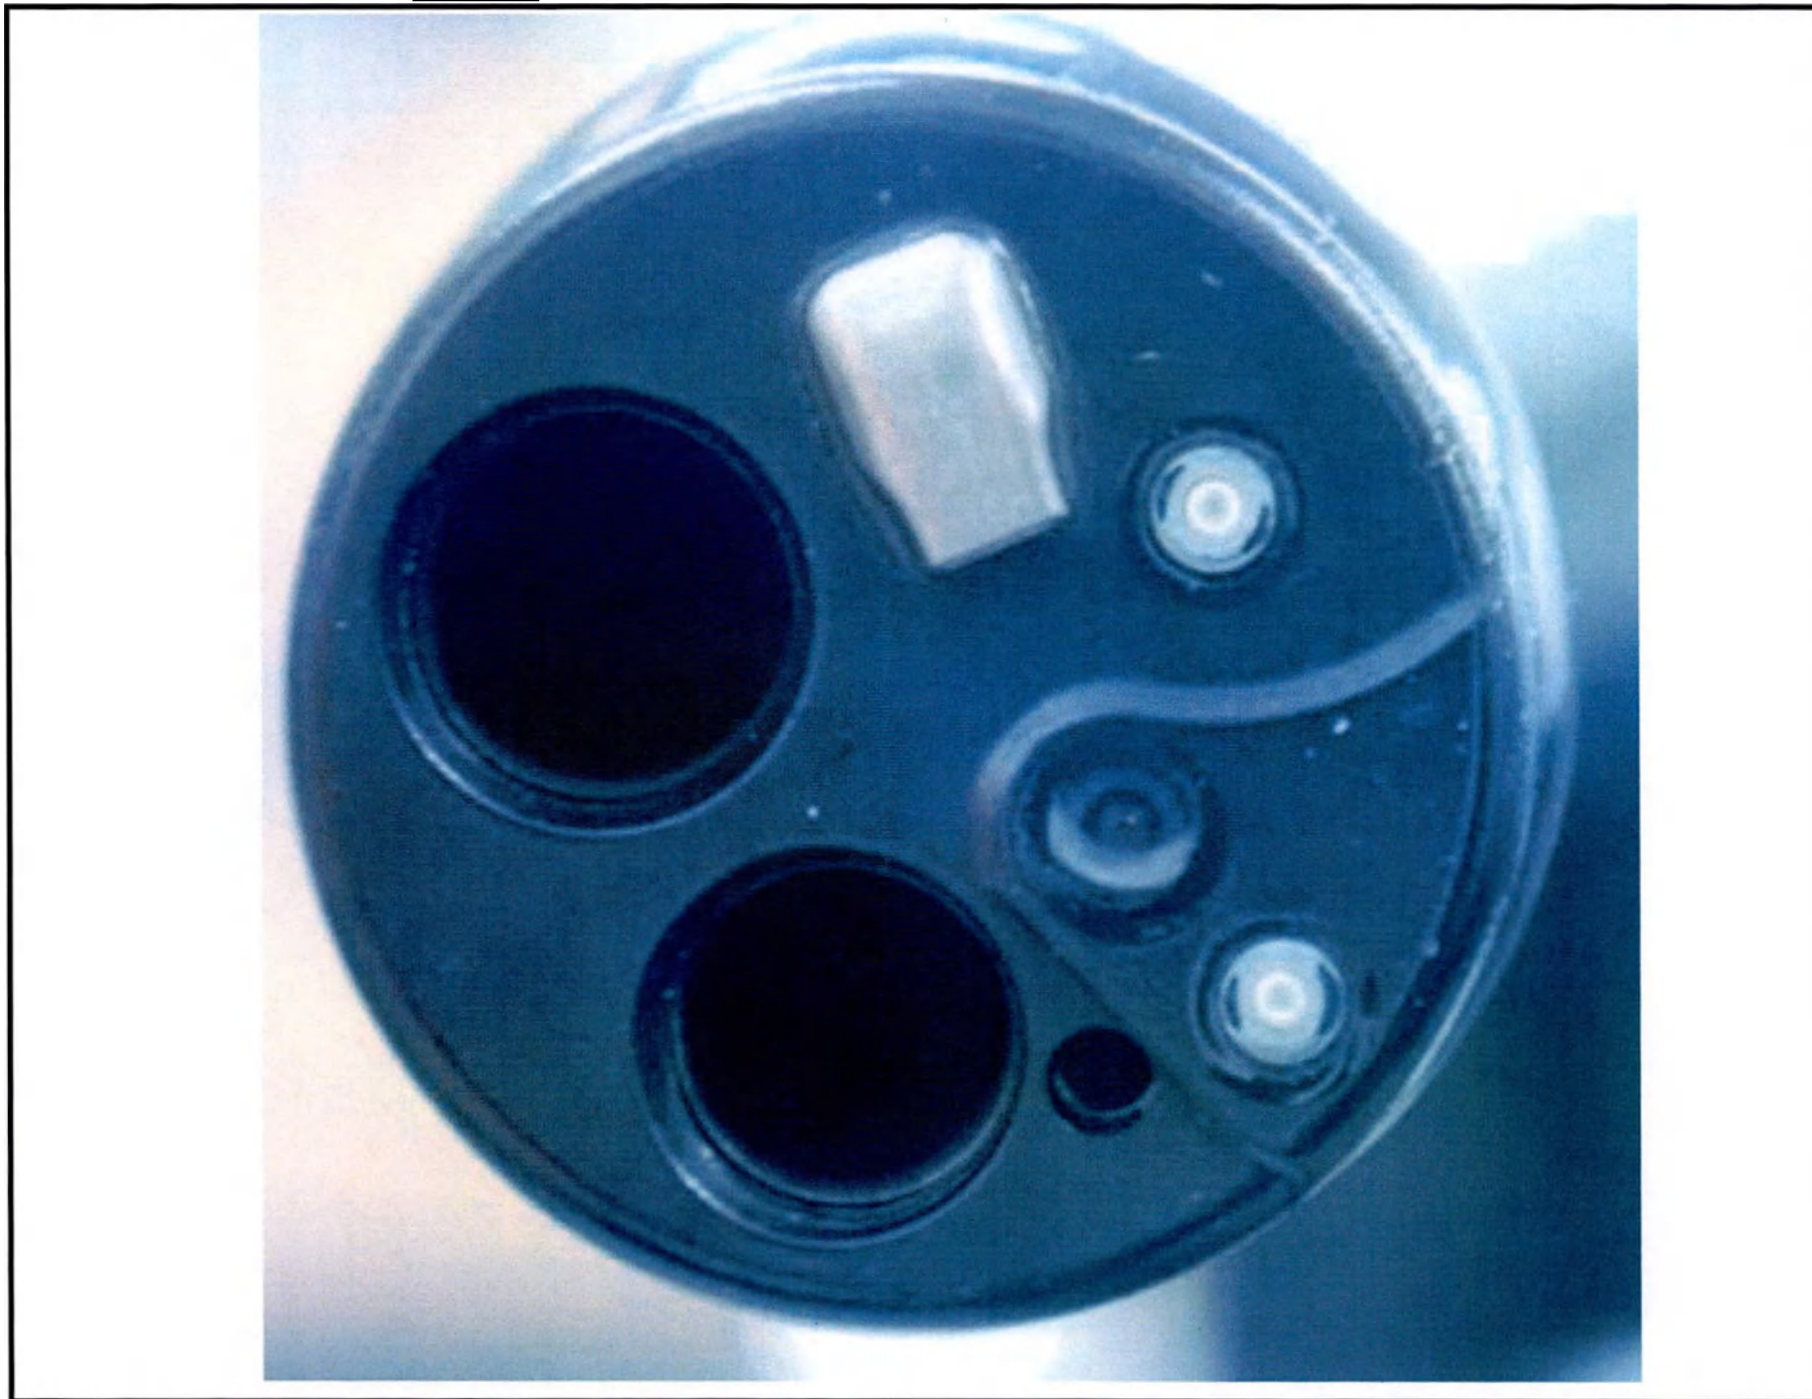


1. Резервуары для воды, в исполнениях: **WT-2**, WT-4, WT-04G, WT-603, WT-604G, WT-1000JW. Резервуар для воды, в исполнении: **WT-2**.



1. Резервуары для воды, в исполнениях: WT-2, **WT-4**, WT-04G, WT-603, WT-604G, WT-1000JW. Резервуар для воды, в исполнении: **WT-4**.

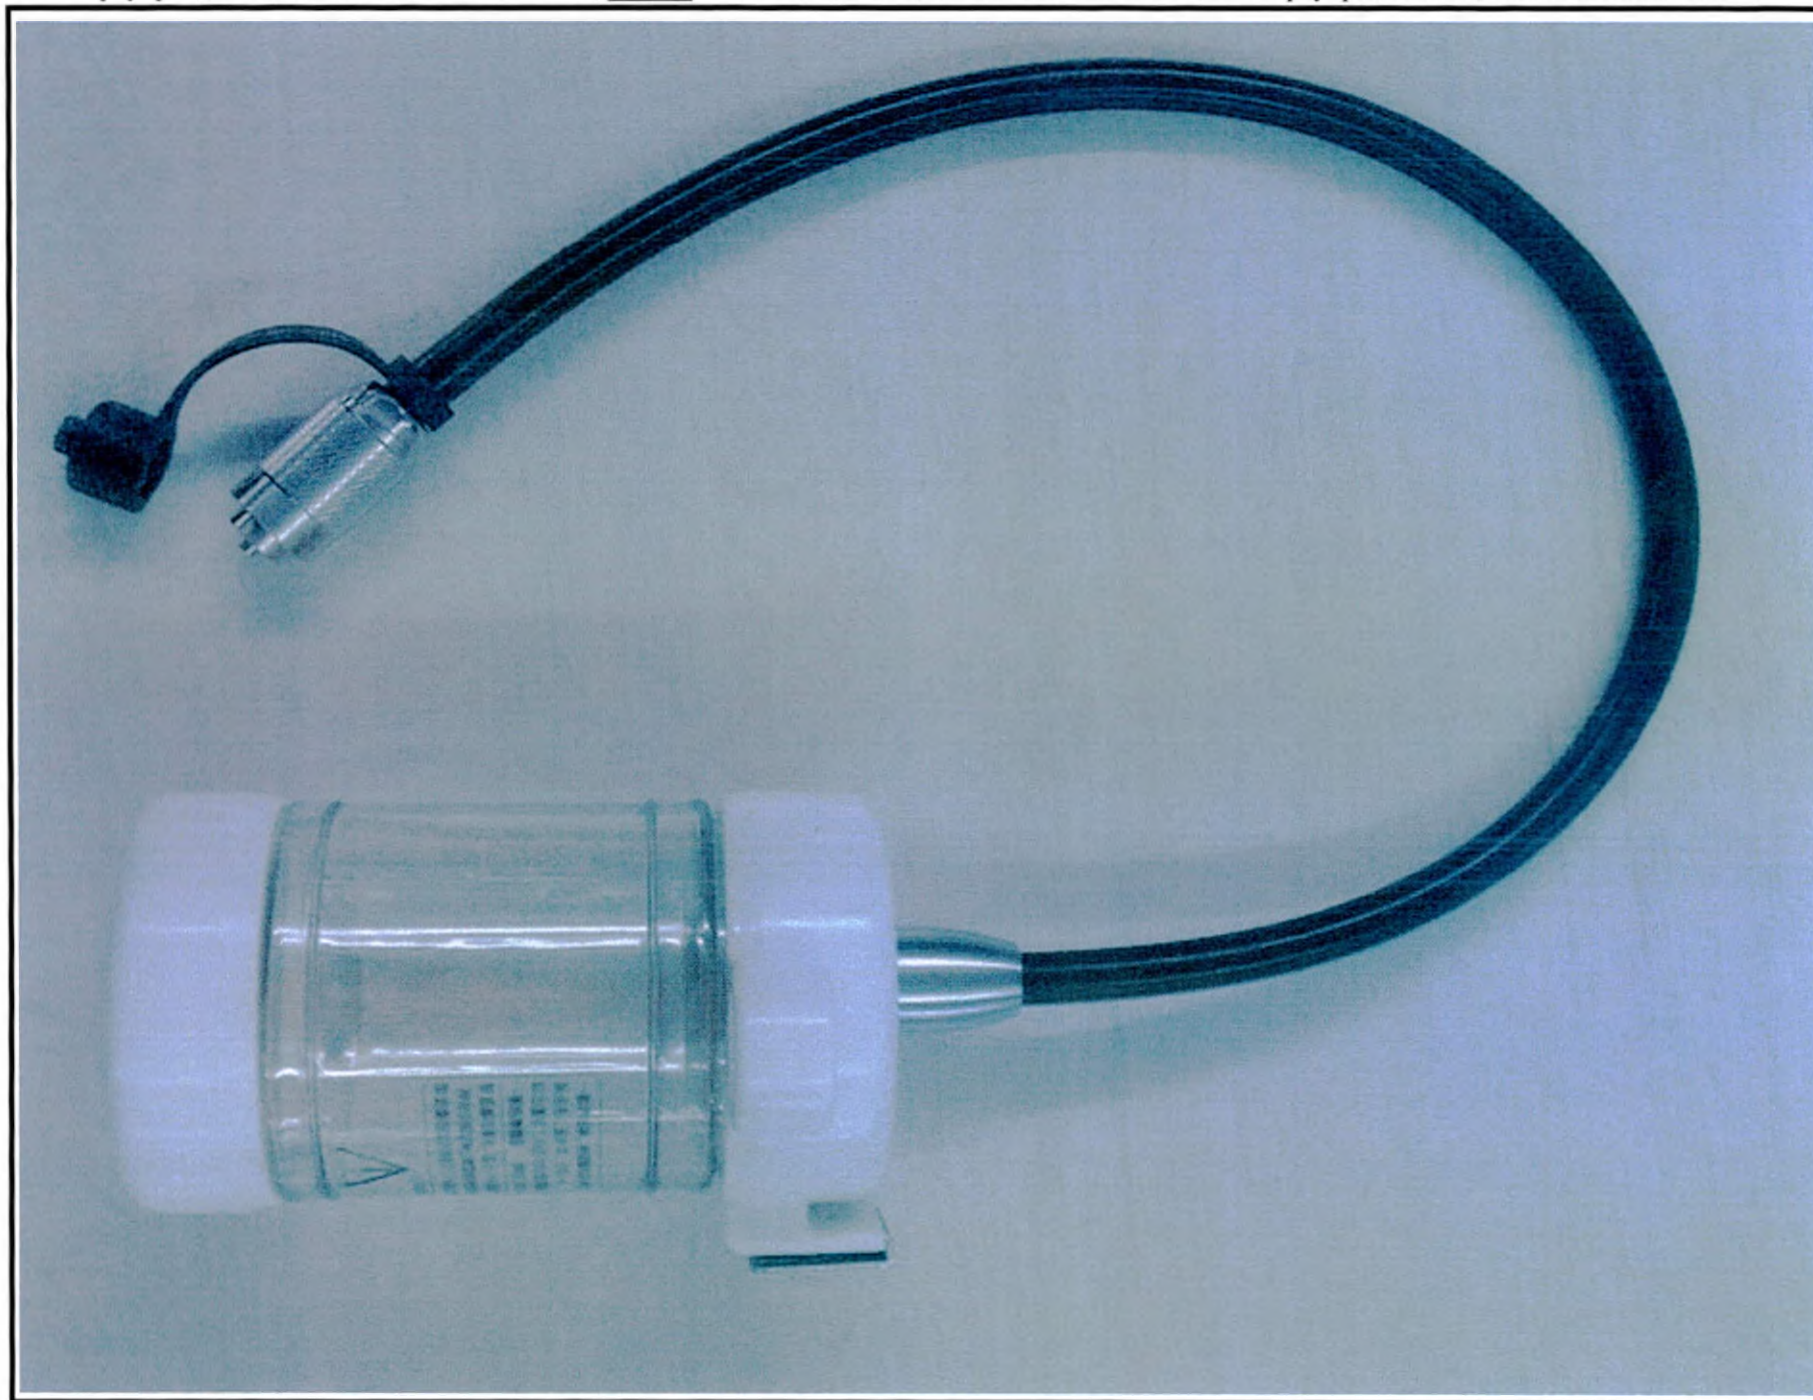

1. Резервуары для воды, в исполнениях: WT-2, WT-4, WT-04G, WT-603, WT-604G, WT-1000JW. Резервуар для воды, в исполнении: WT-04G.

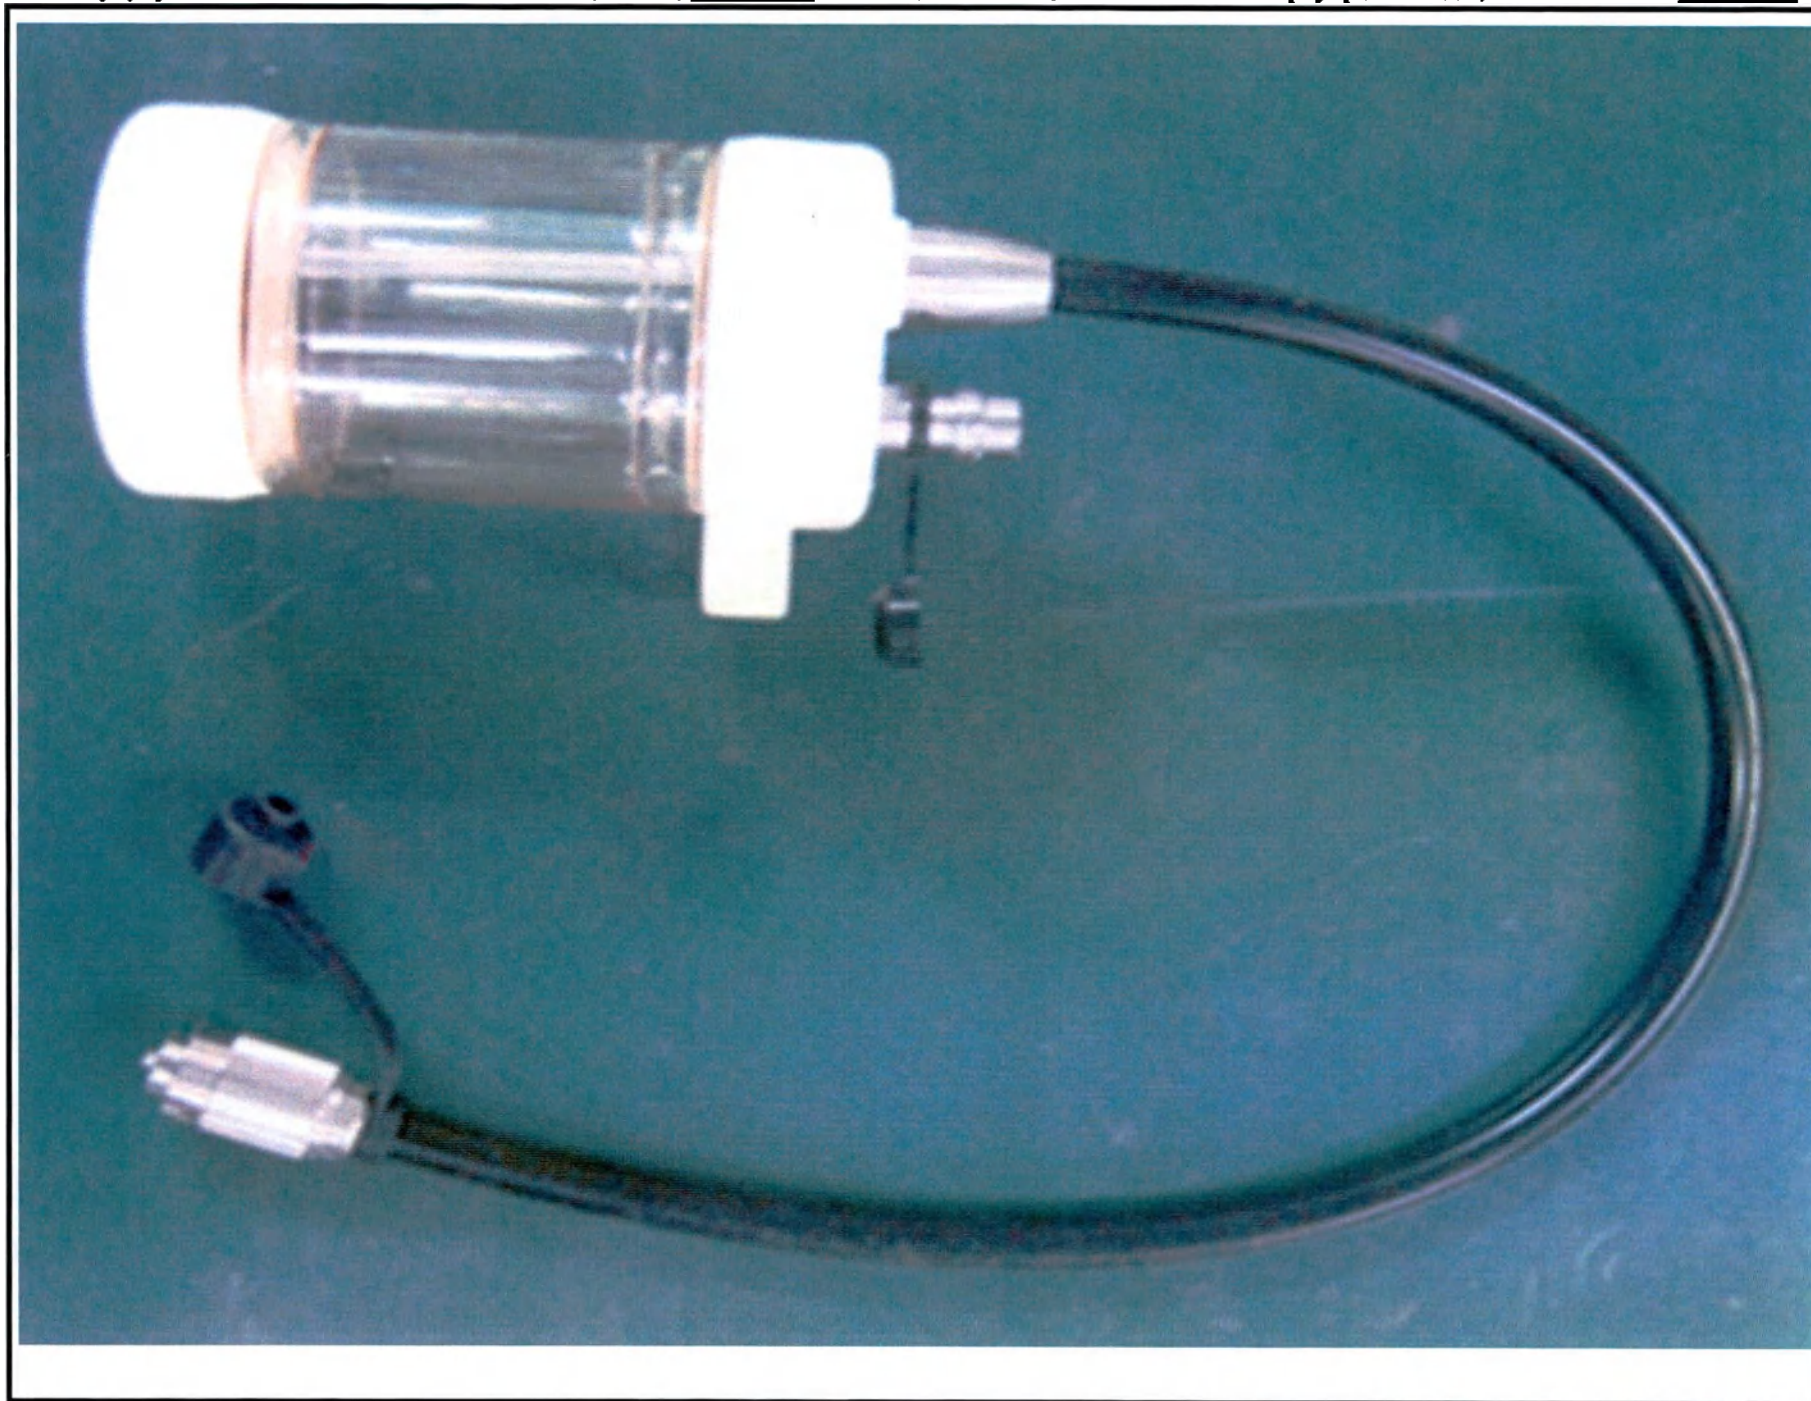

1. Резервуары для воды, в исполнениях: WT-2, WT-4, WT-04G, WT-603, WT-604G, WT-1000JW. Резервуар для воды, в исполнении: WT-603.





1. Резервуары для воды, в исполнениях: WT-2, WT-4, WT-04G, WT-603, **WT-604G**, WT-1000JW. Резервуар для воды, в исполнении: **WT-604G**.



1. Резервуары для воды, в исполнениях: WT-2, WT-4, WT-04G, WT-603, WT-604G, **WT-1000JW**. Резервуар для воды, в исполнении: **WT-1000JW**.



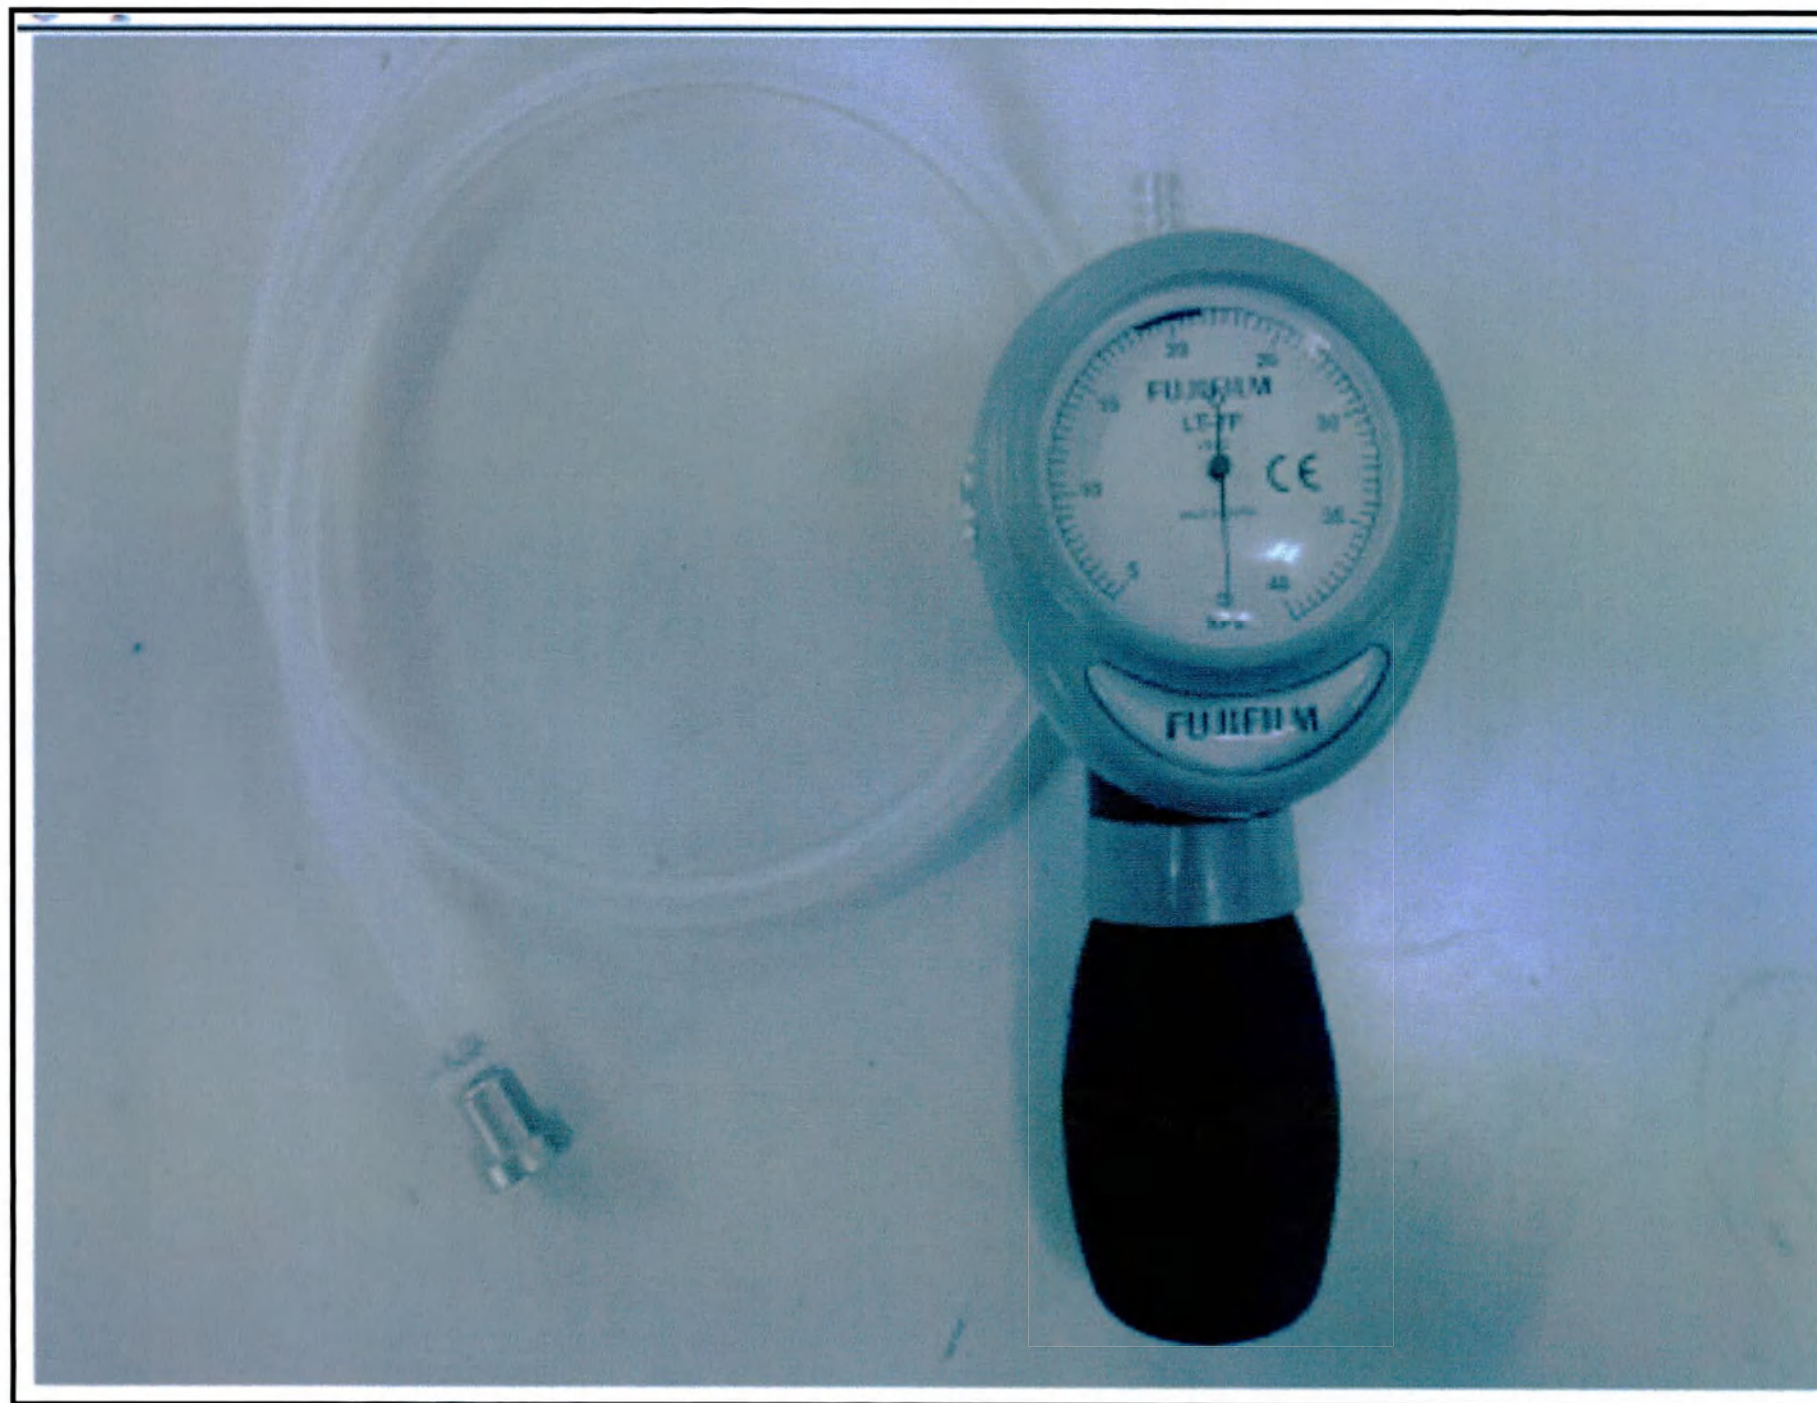


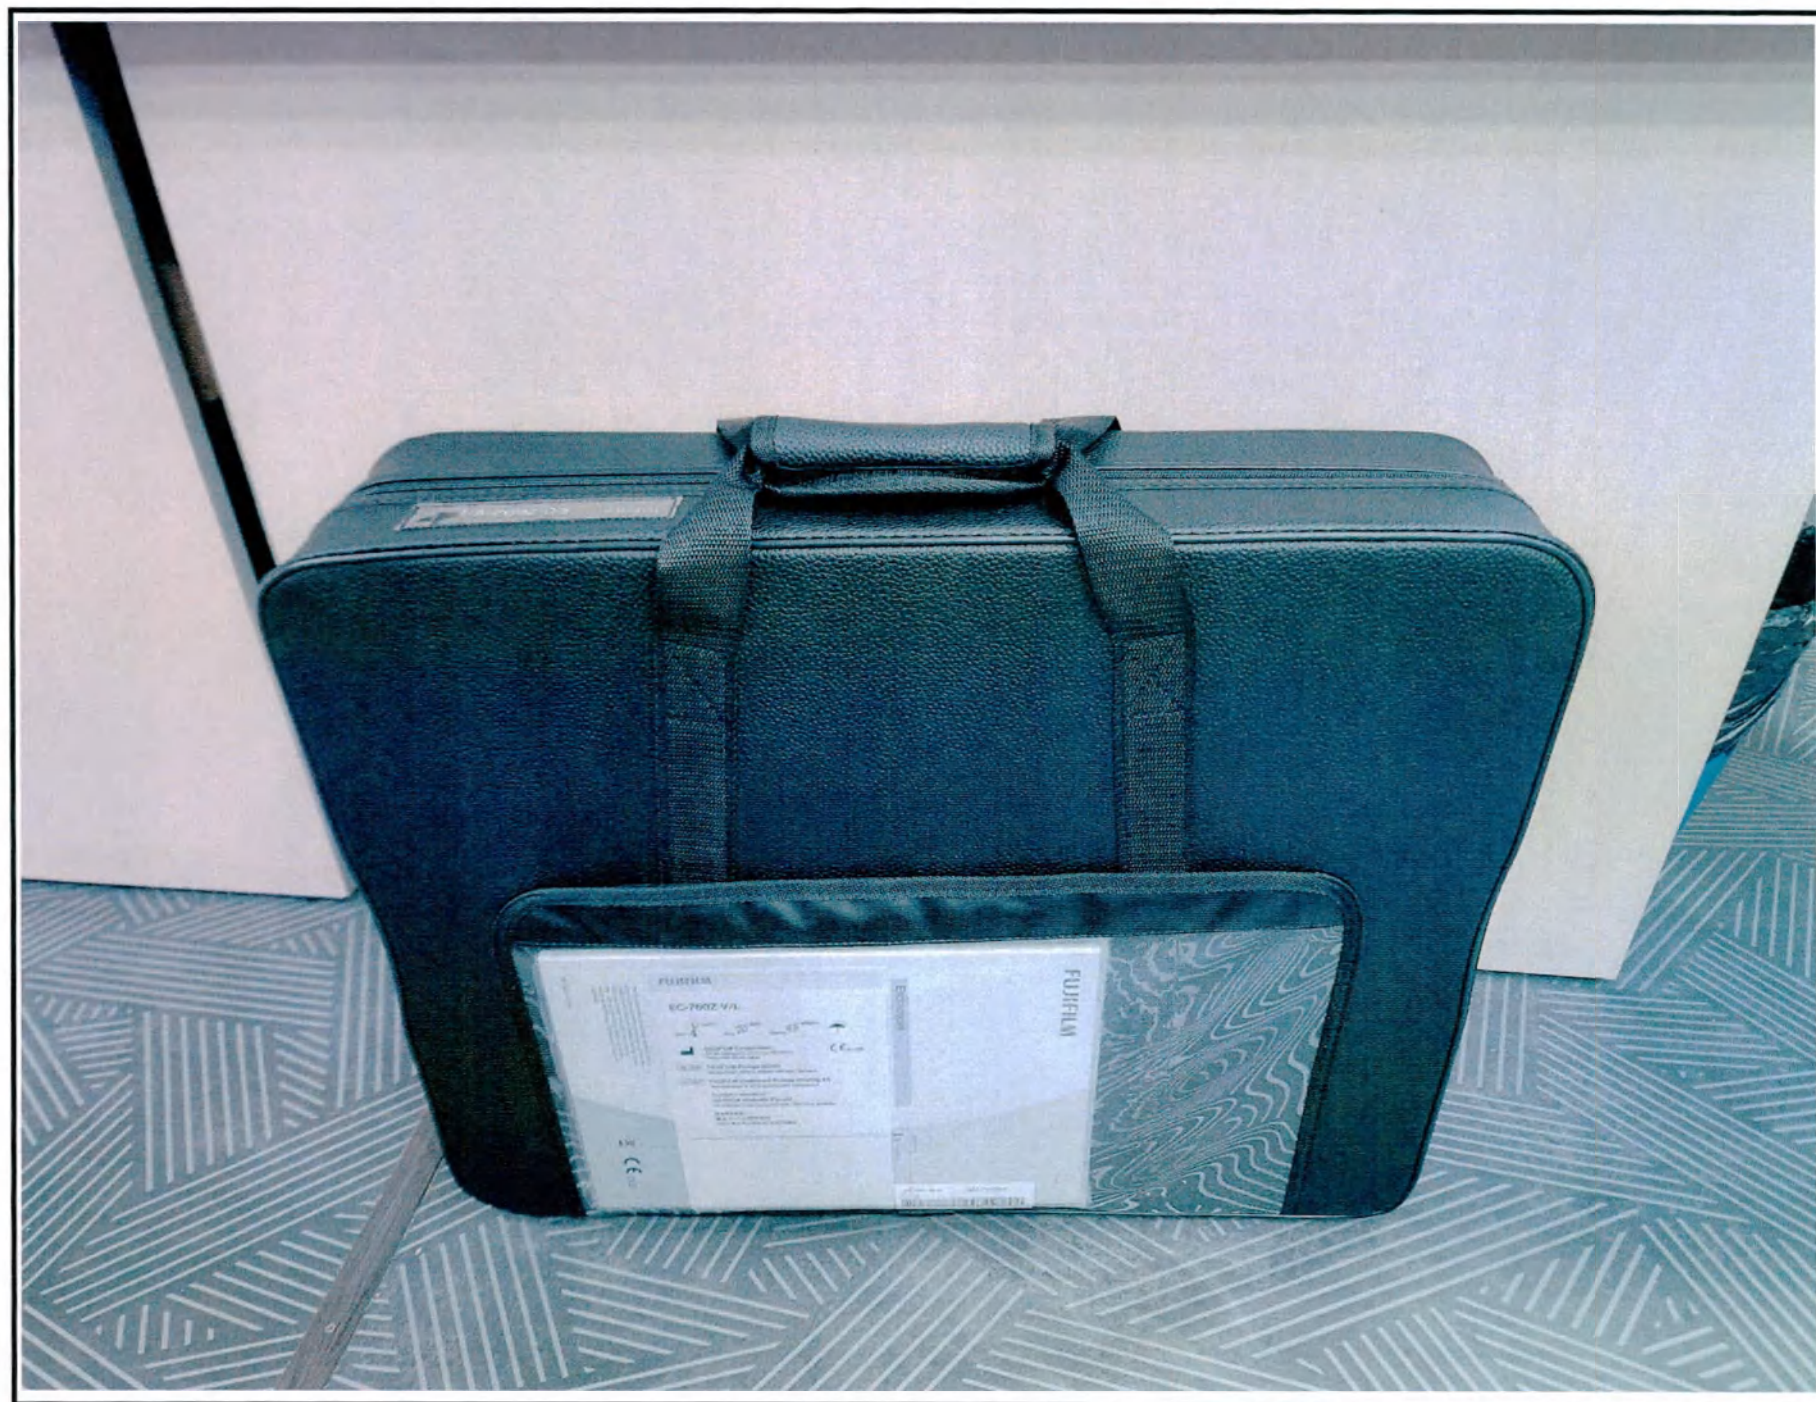









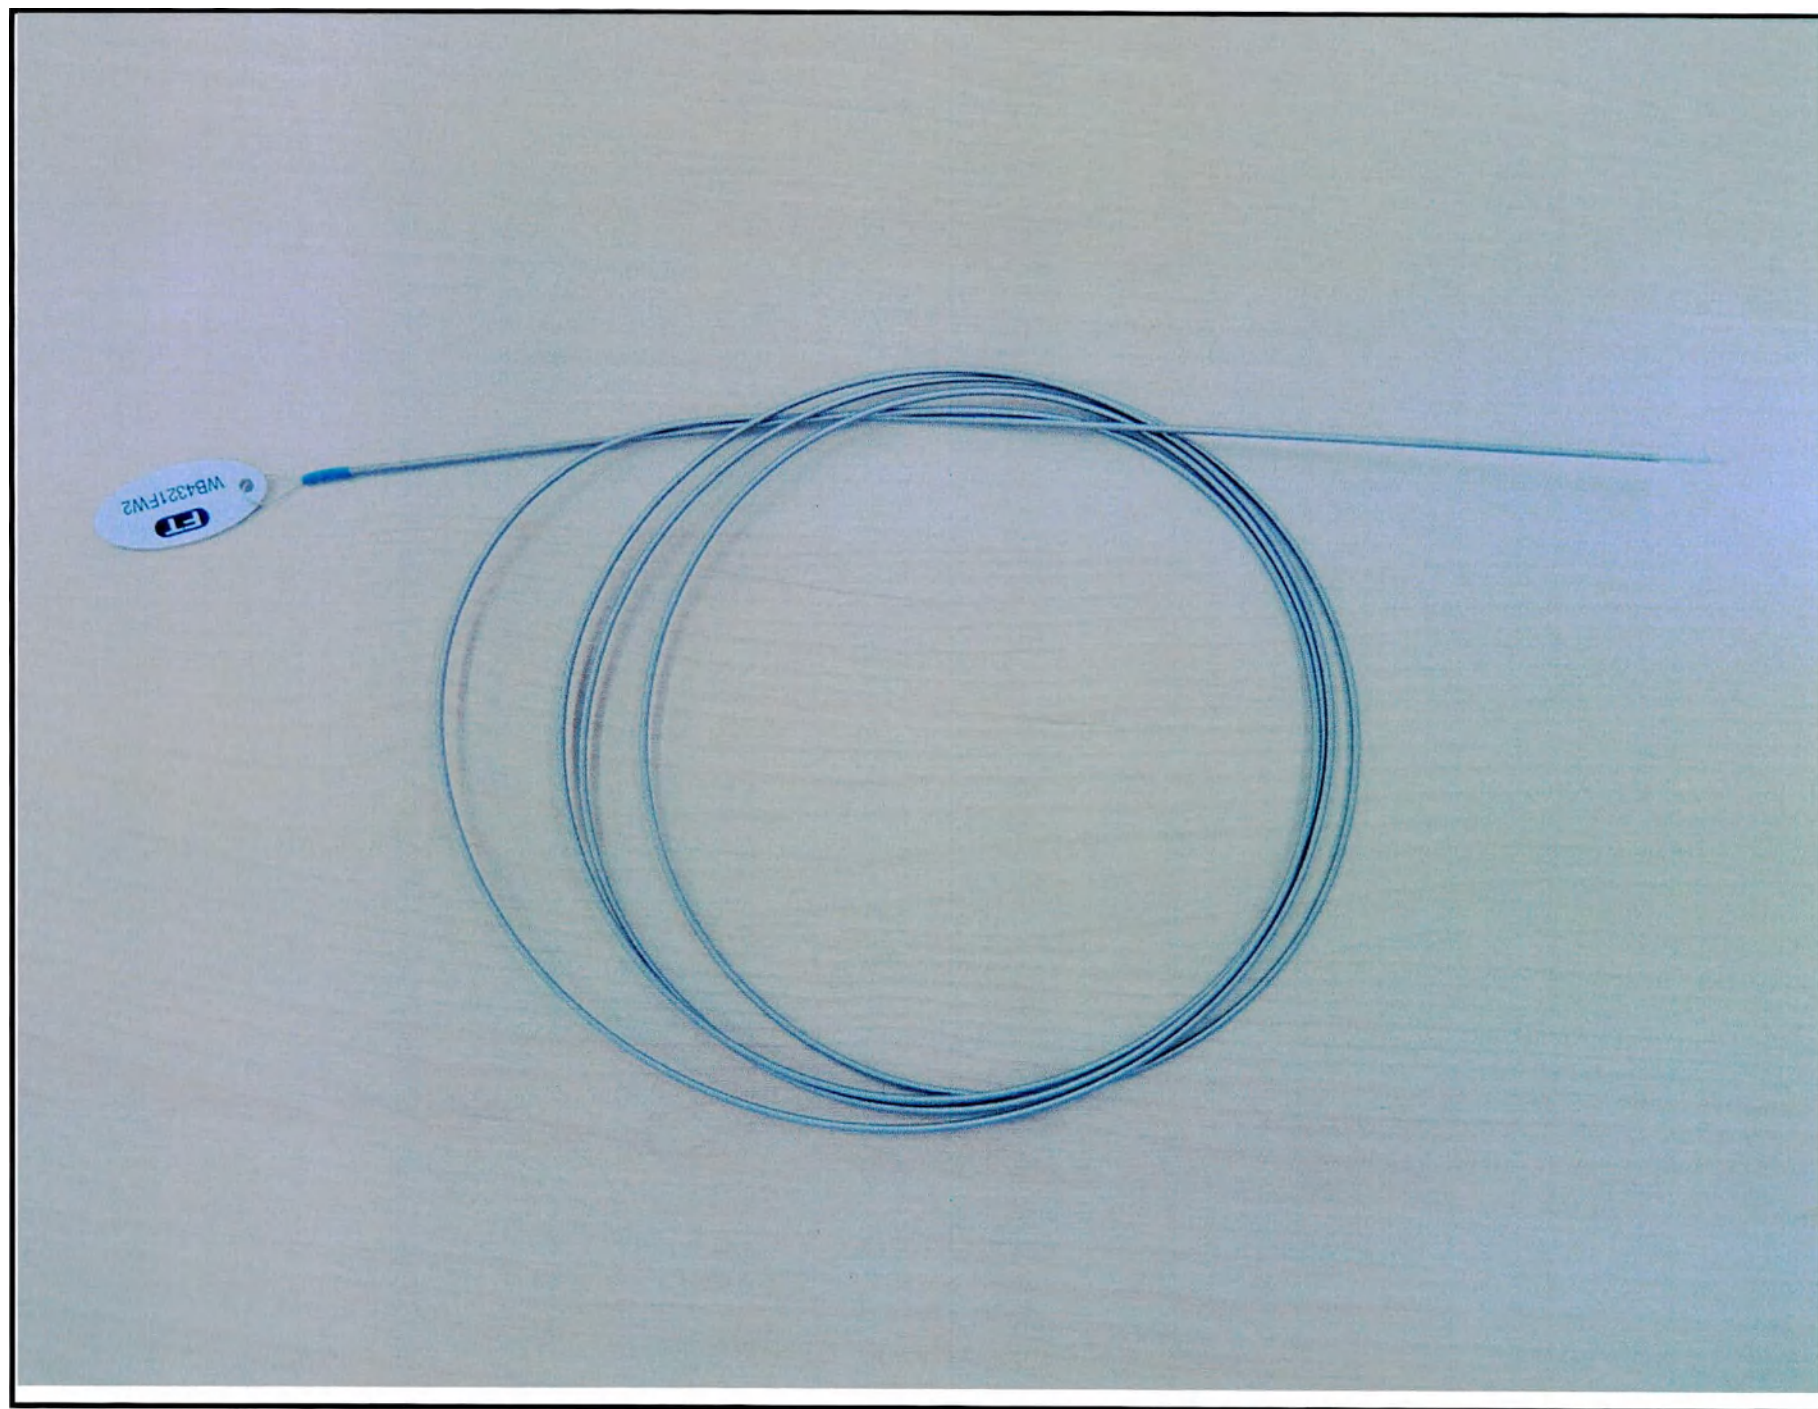

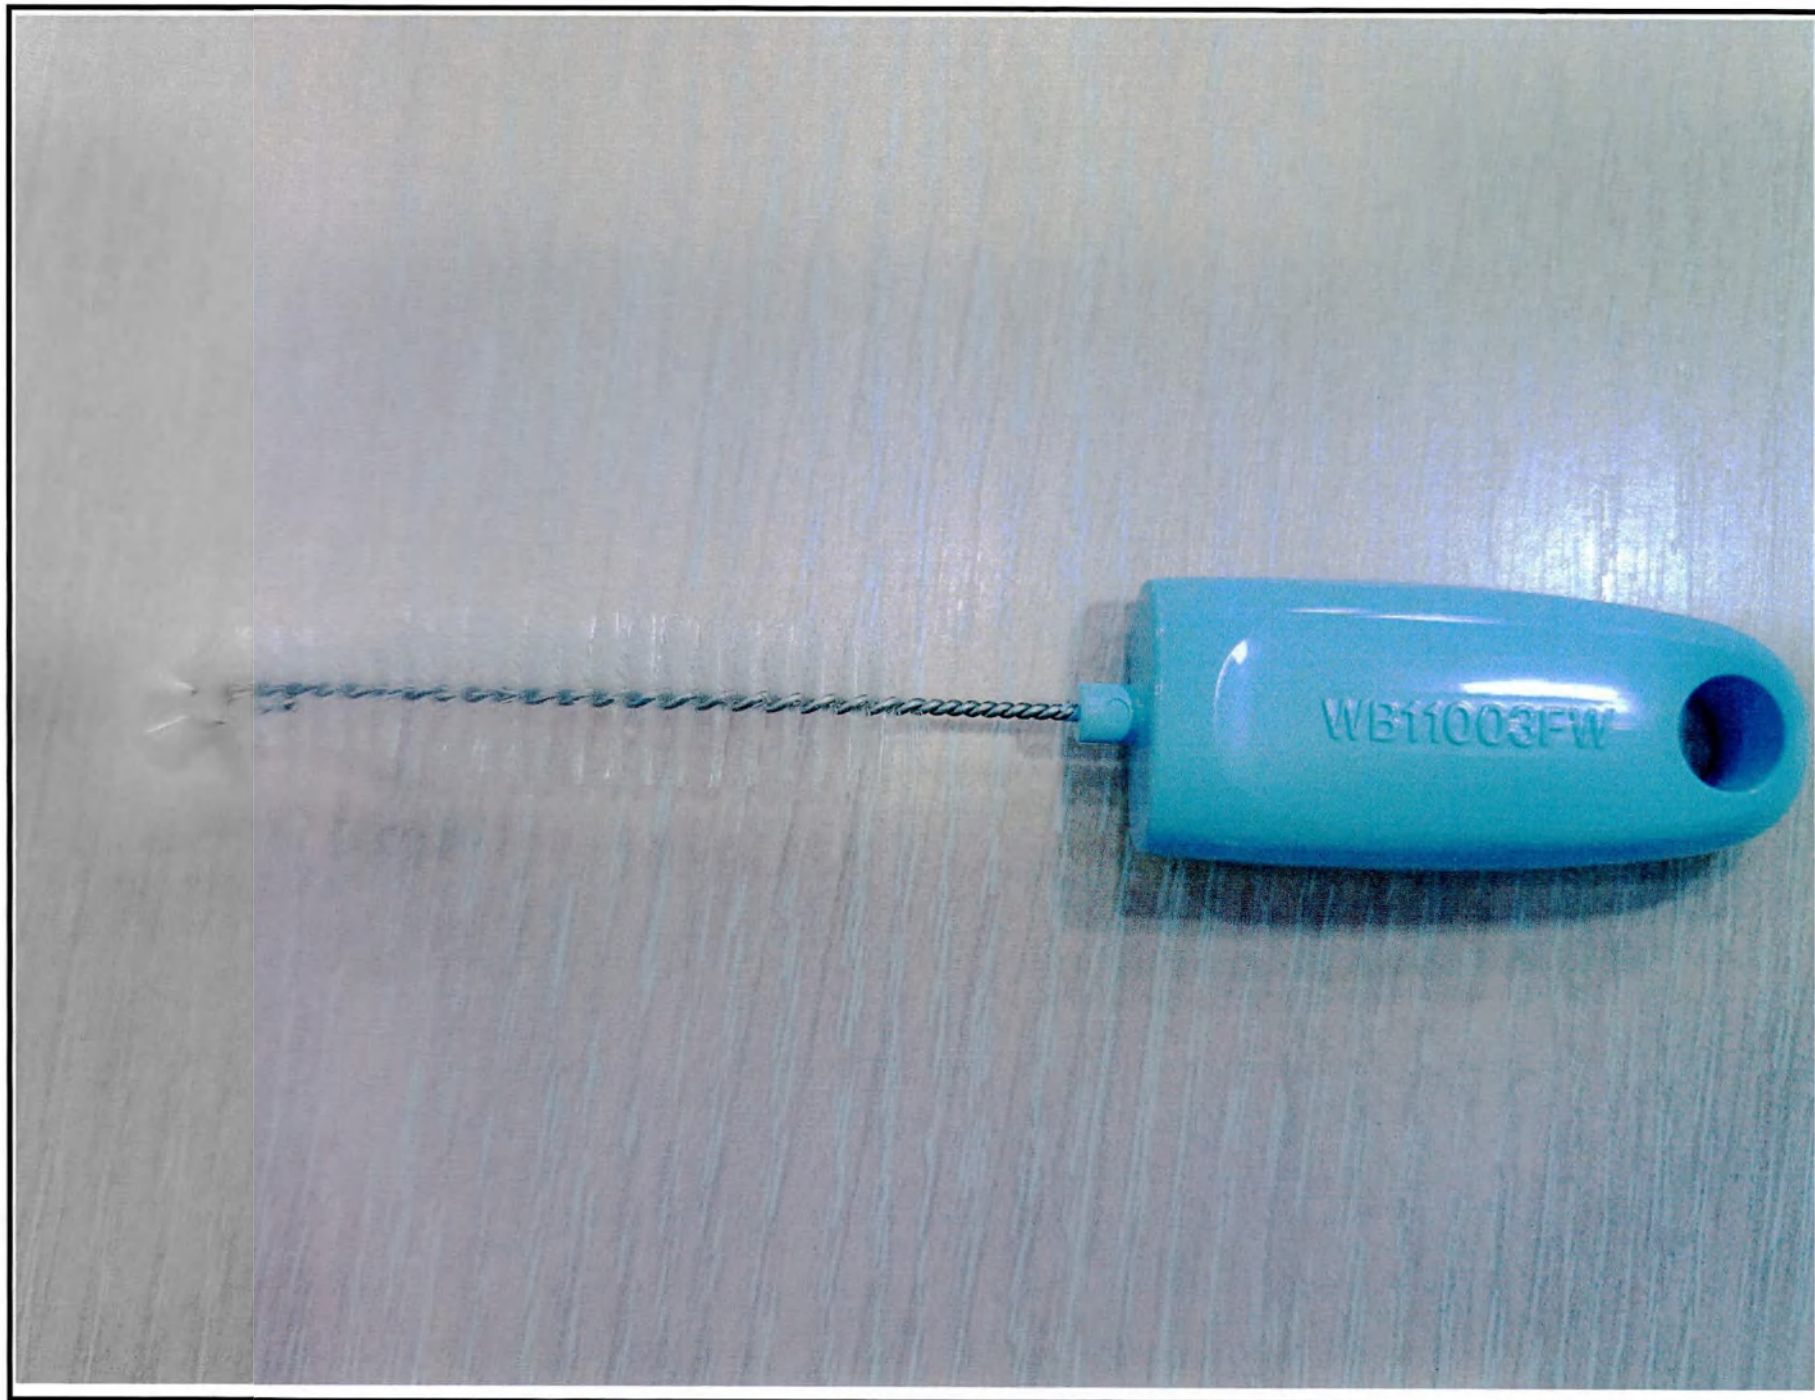


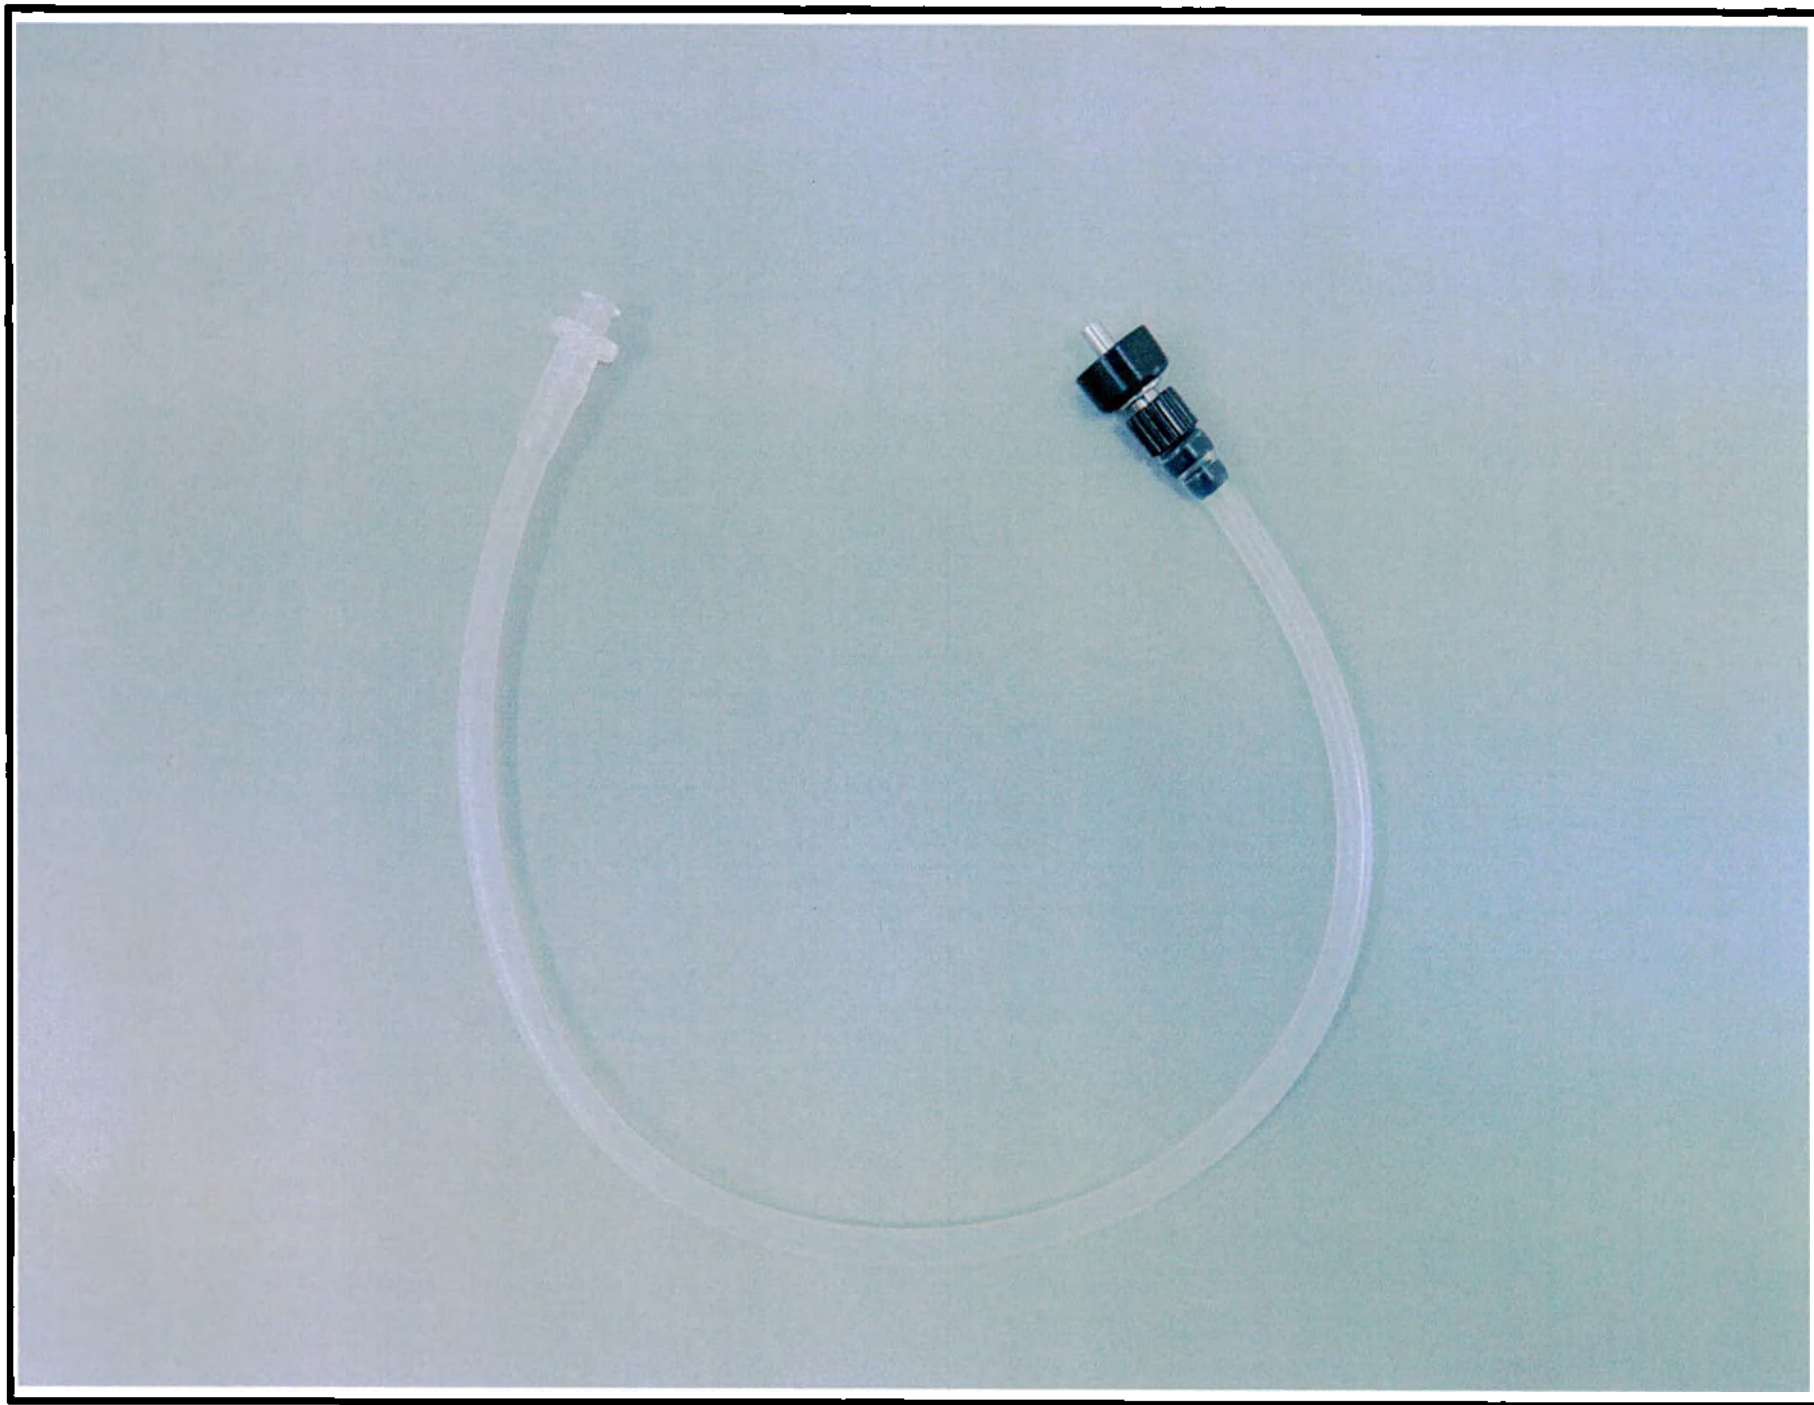








Вариант исполнения: **AW-500/G**

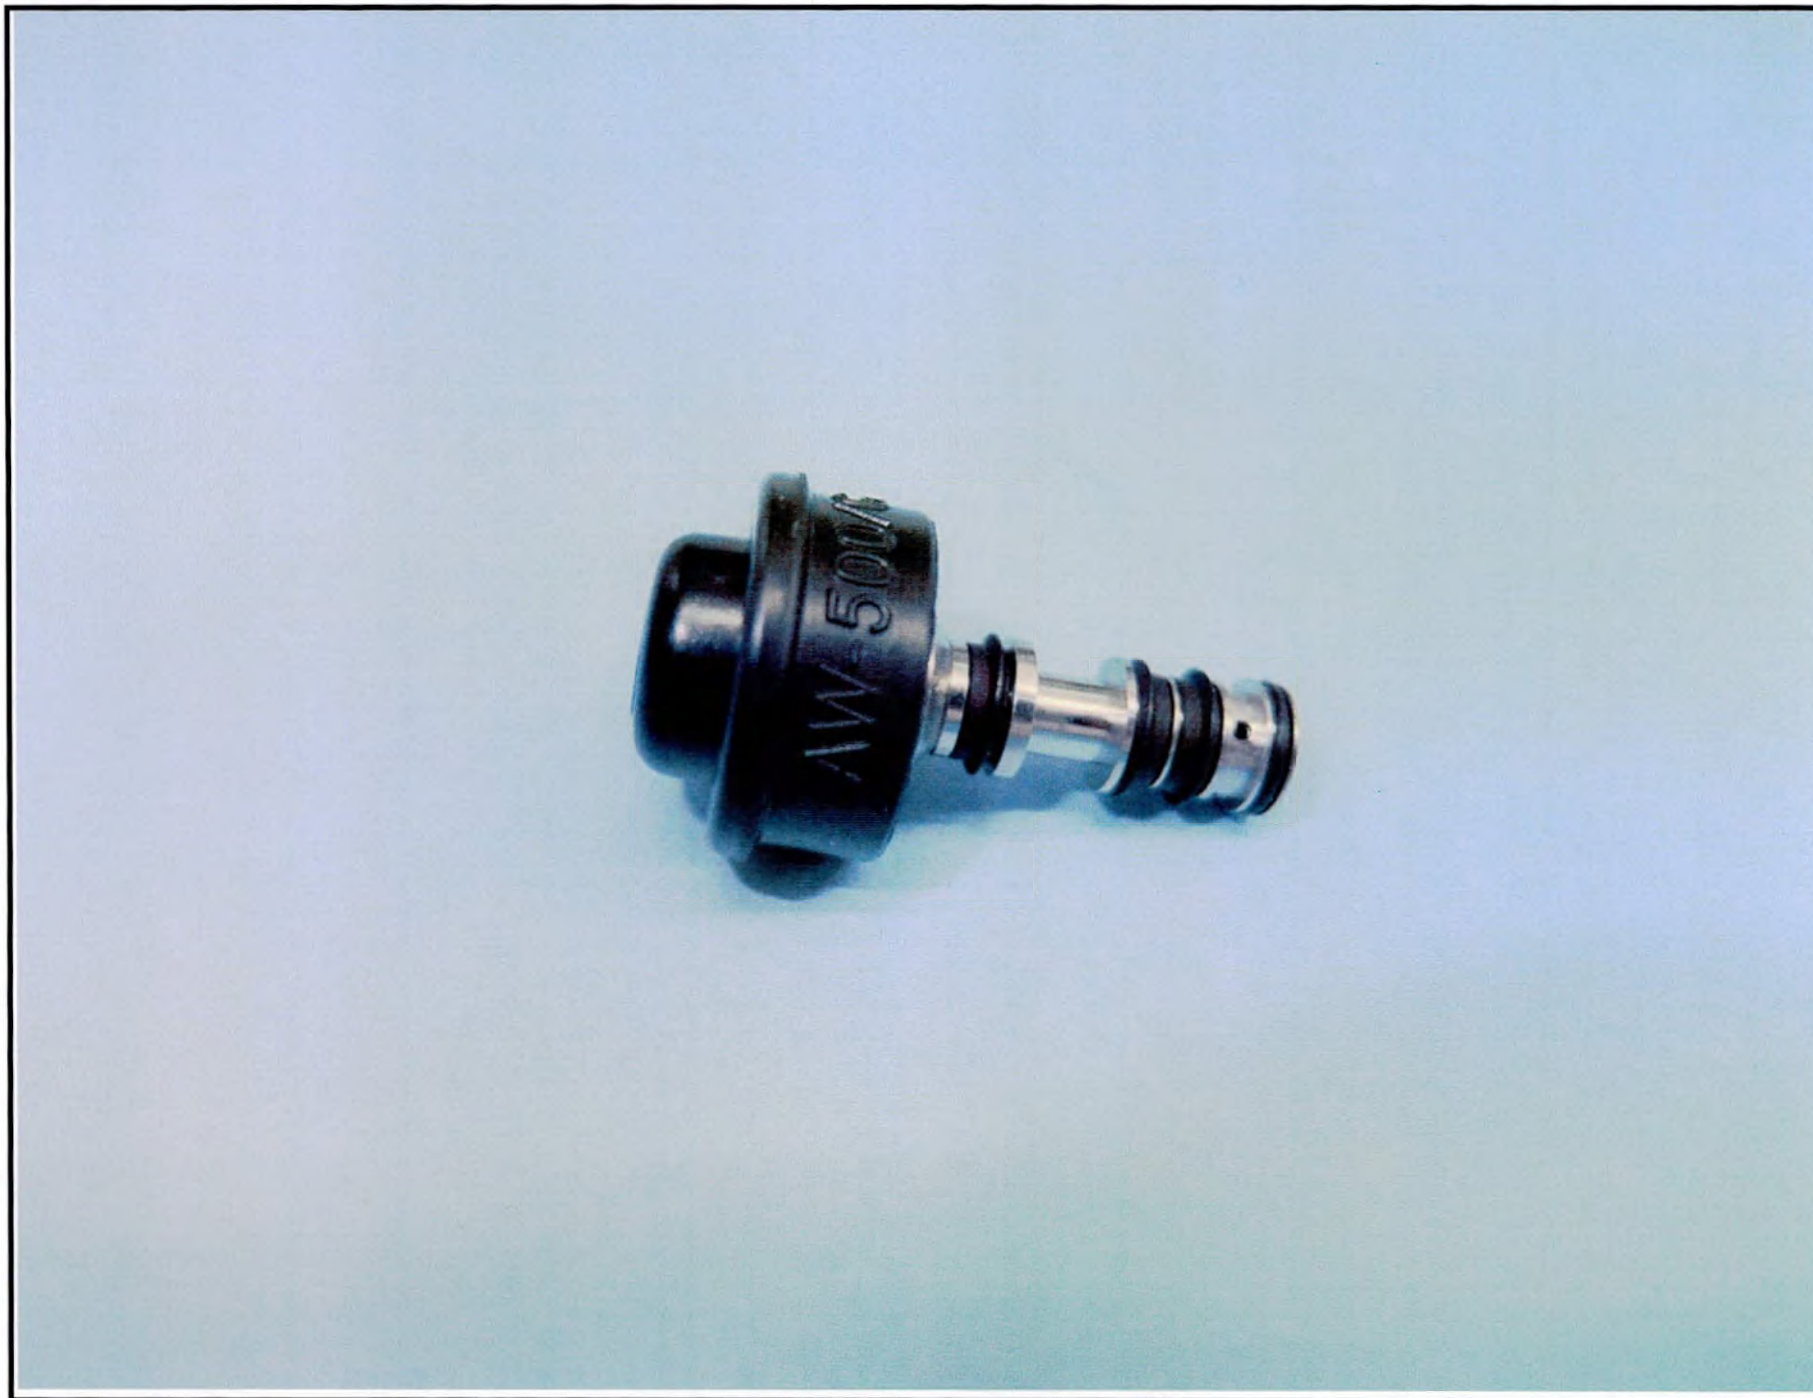

Вариант исполнения: **AW-603.**

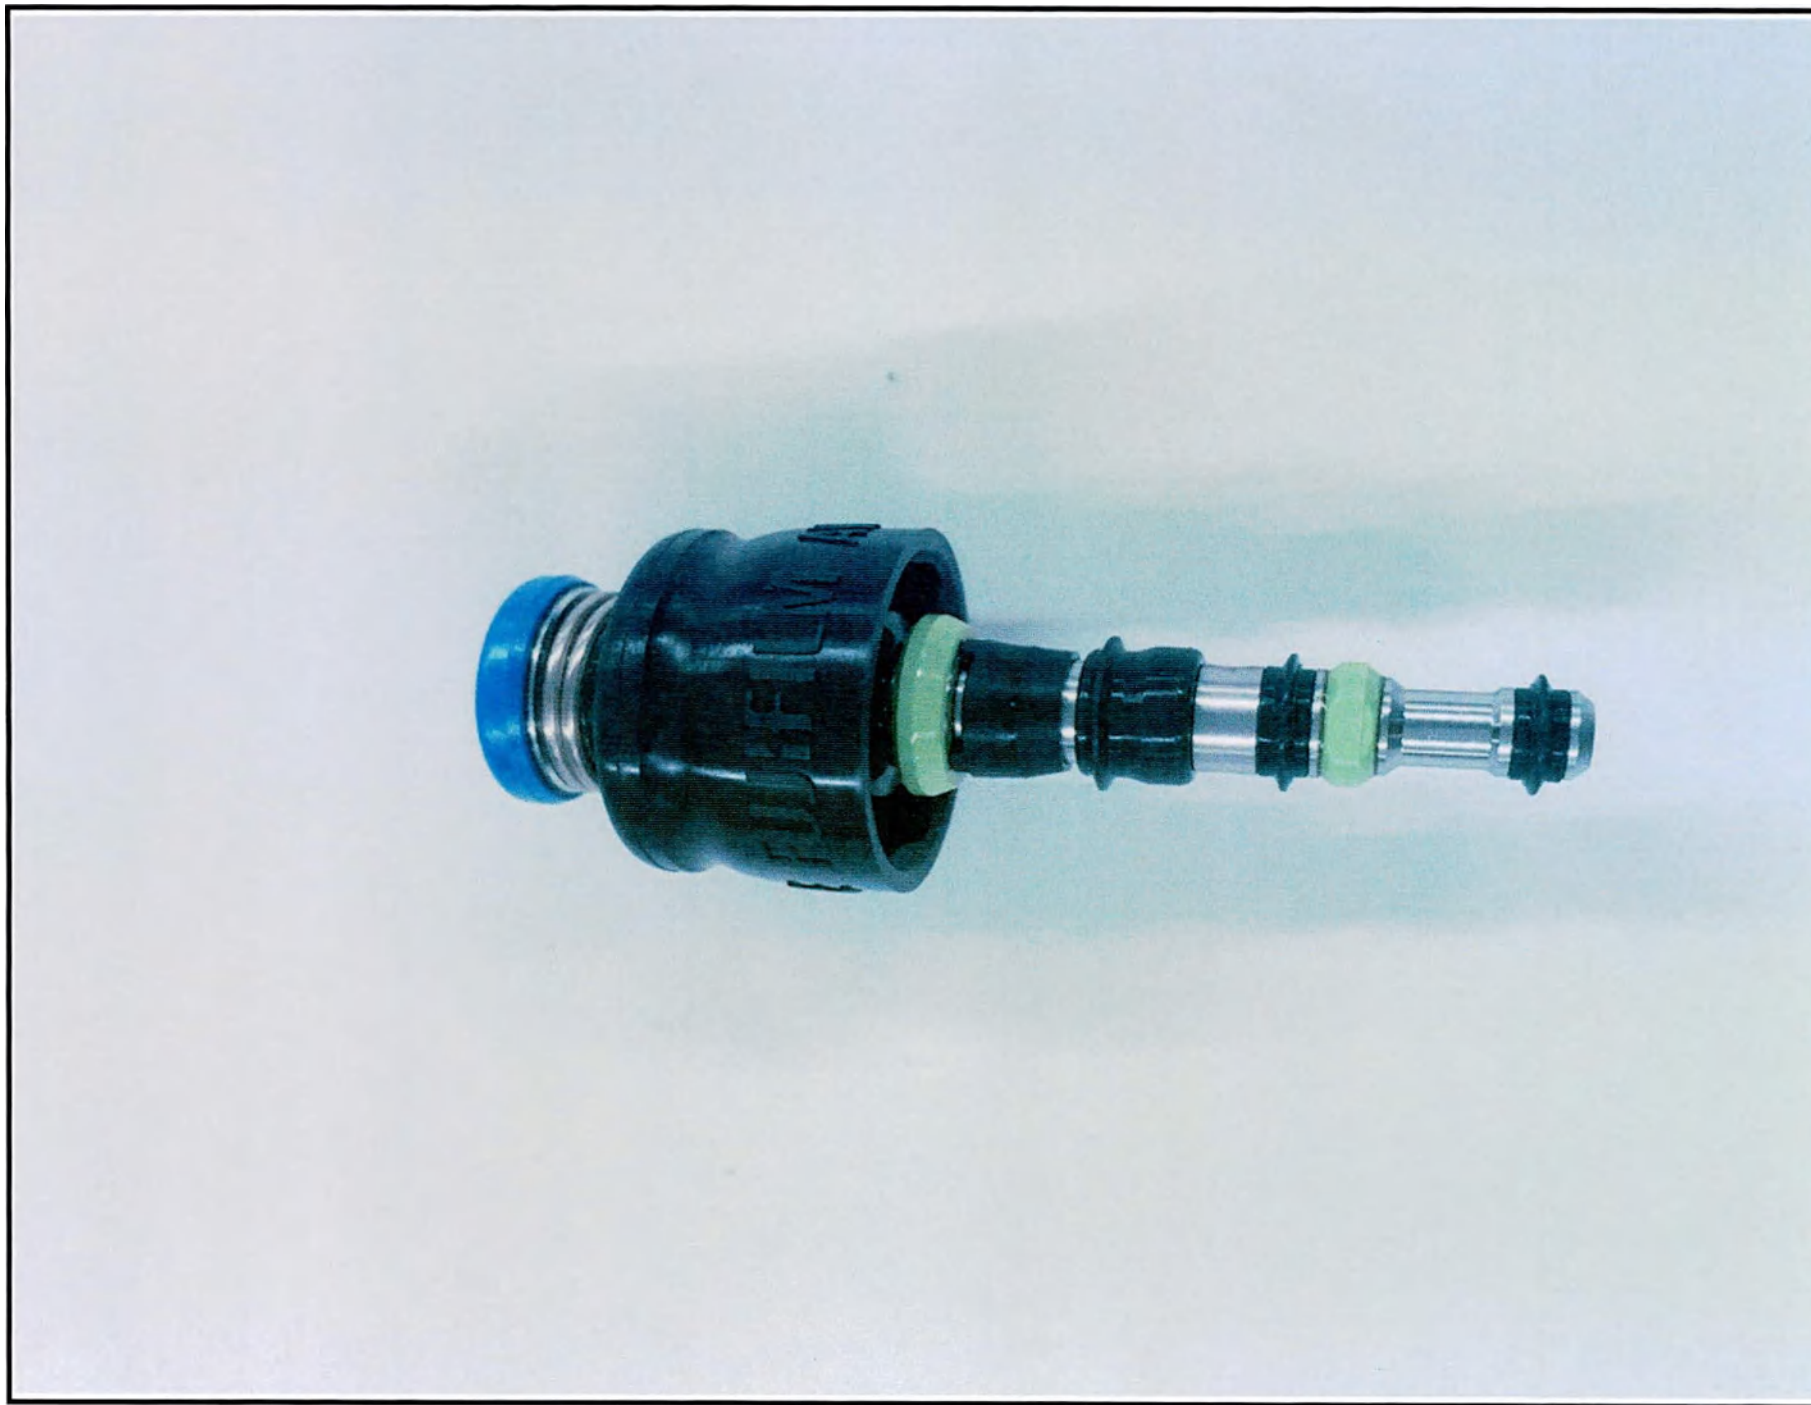

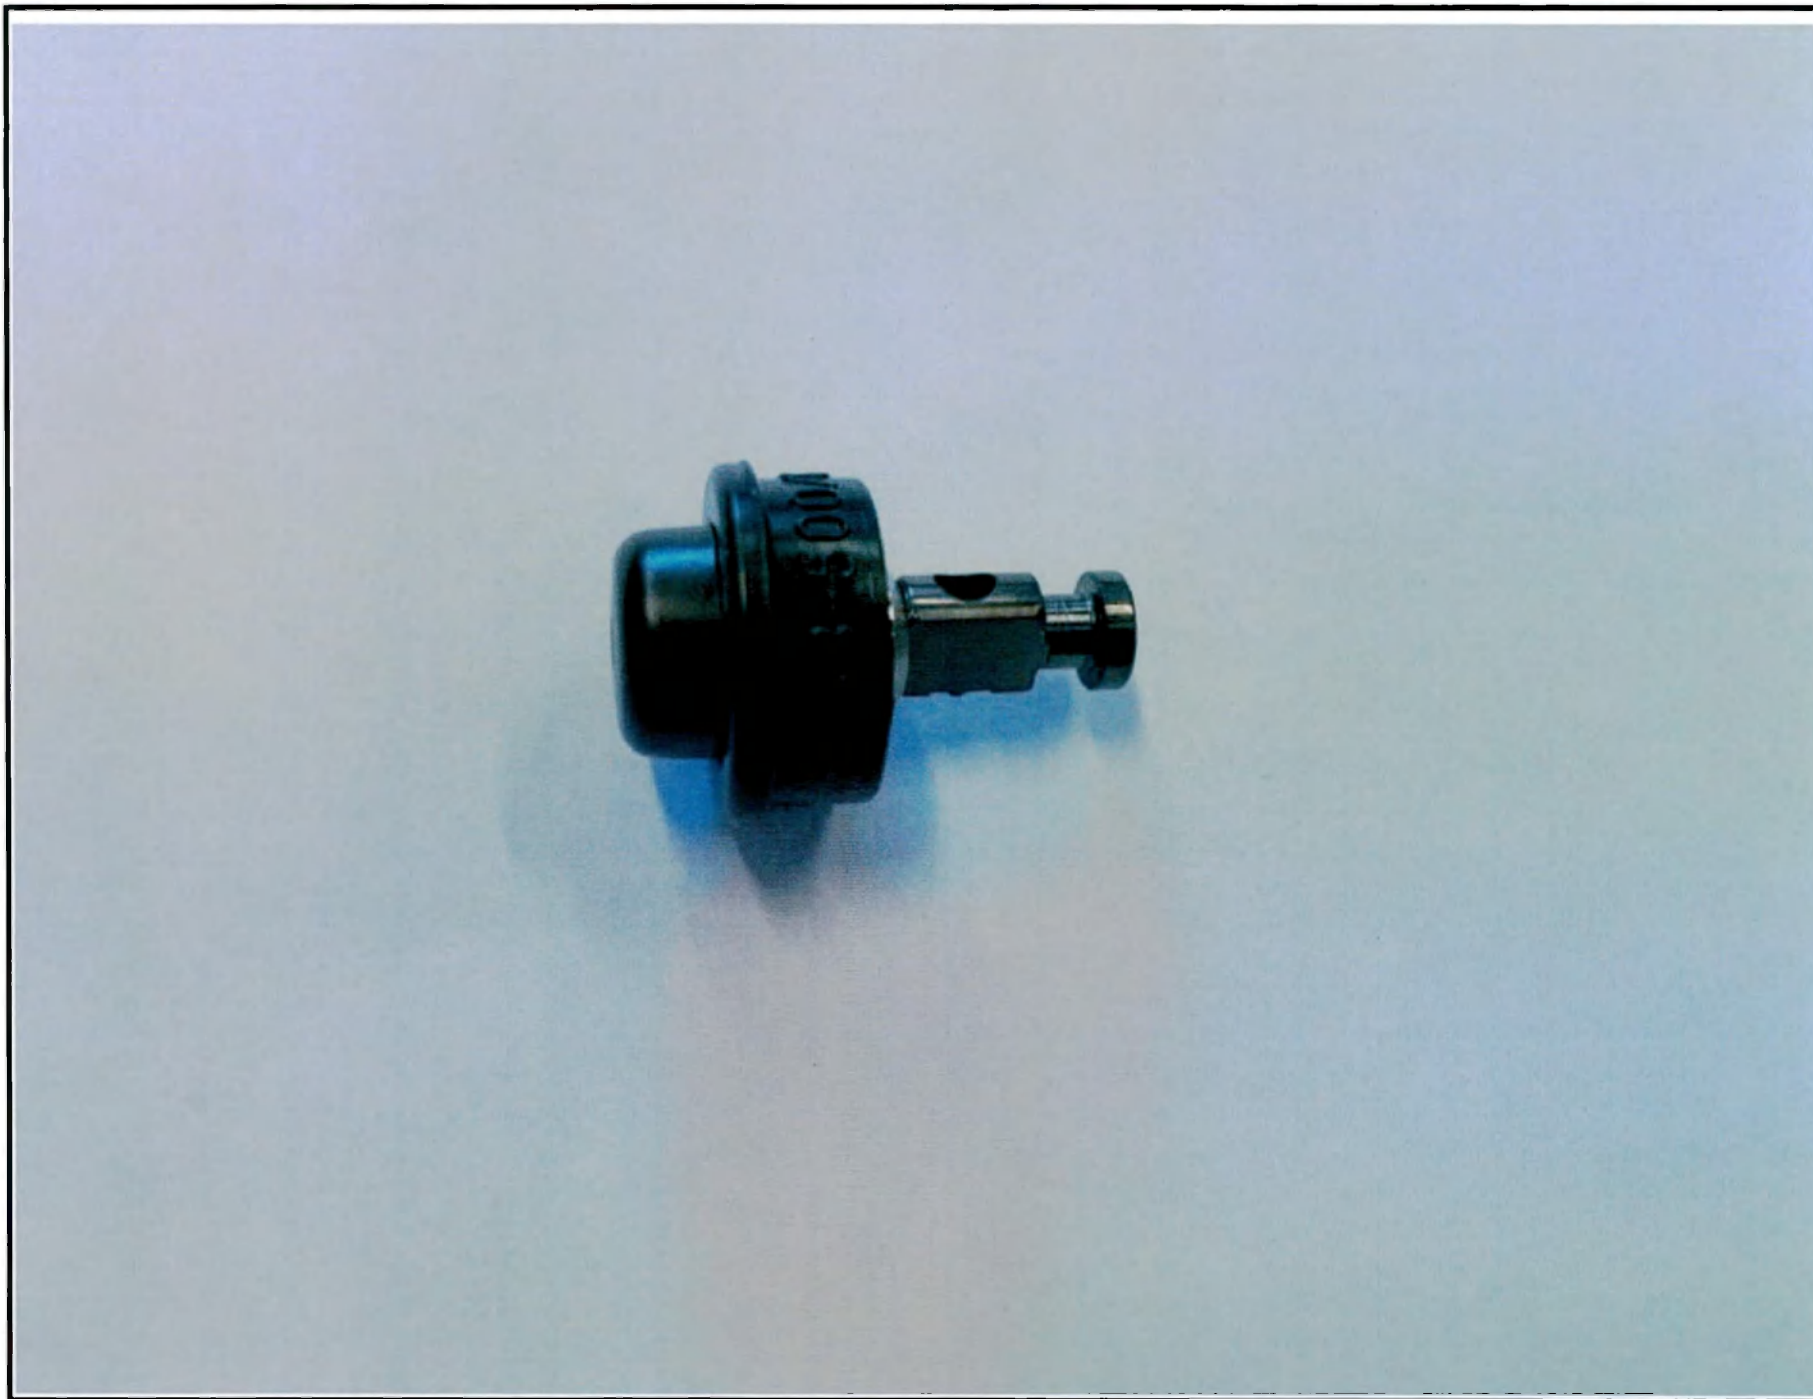

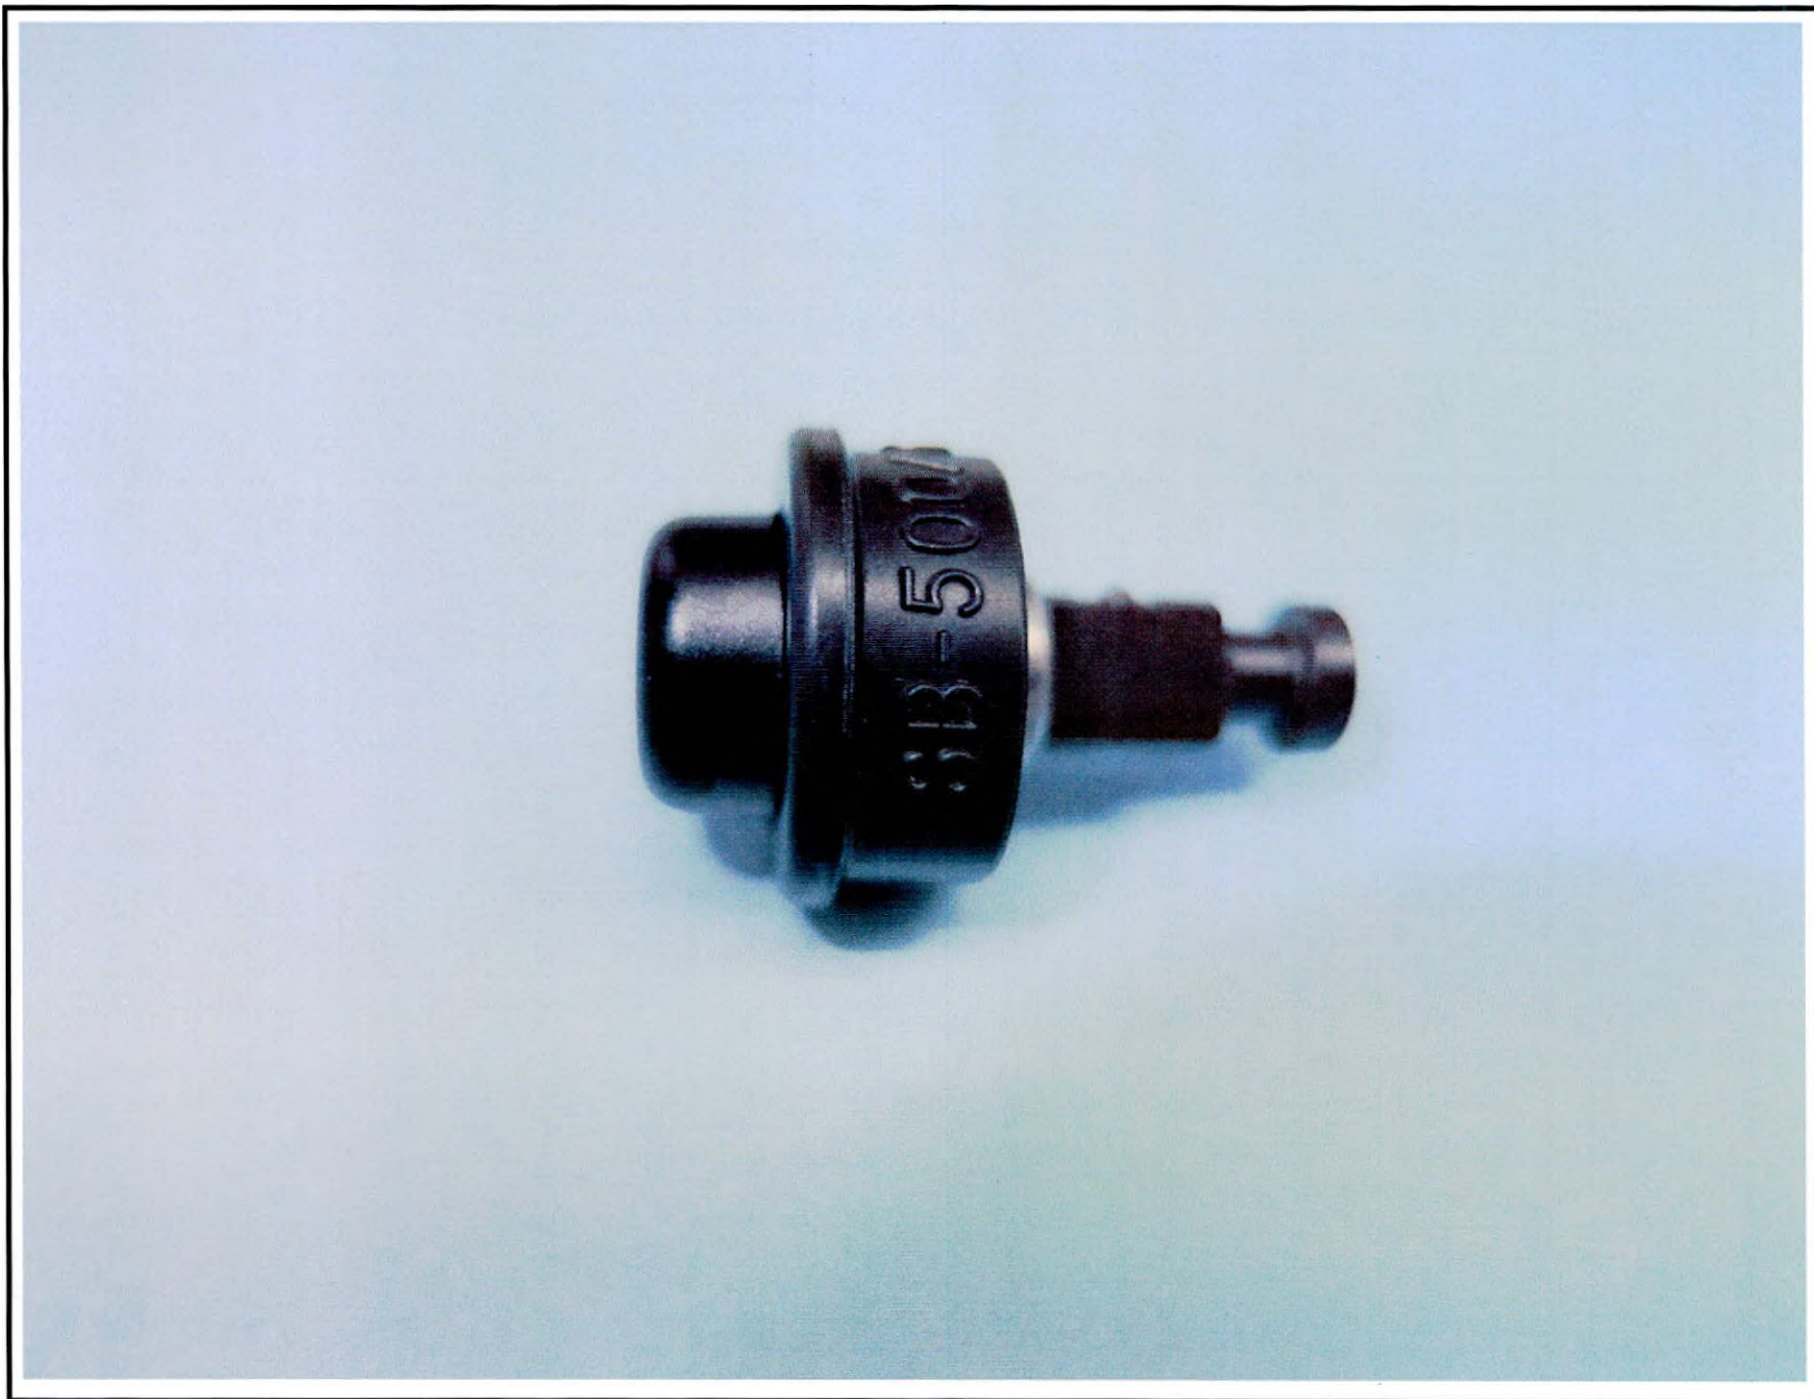




11. Адаптеры для очистки эндоскопов, в исполнениях: CA-503/A, AJ-500, AJ-500L, WA-5003, WA-500, WA-501, CA-511N, CA-010, CA 74-611, CA-613, CA-614, CA-617, WA-007, WA-010, WA-501, JT-500. Вариант исполнения: CA-503/A.











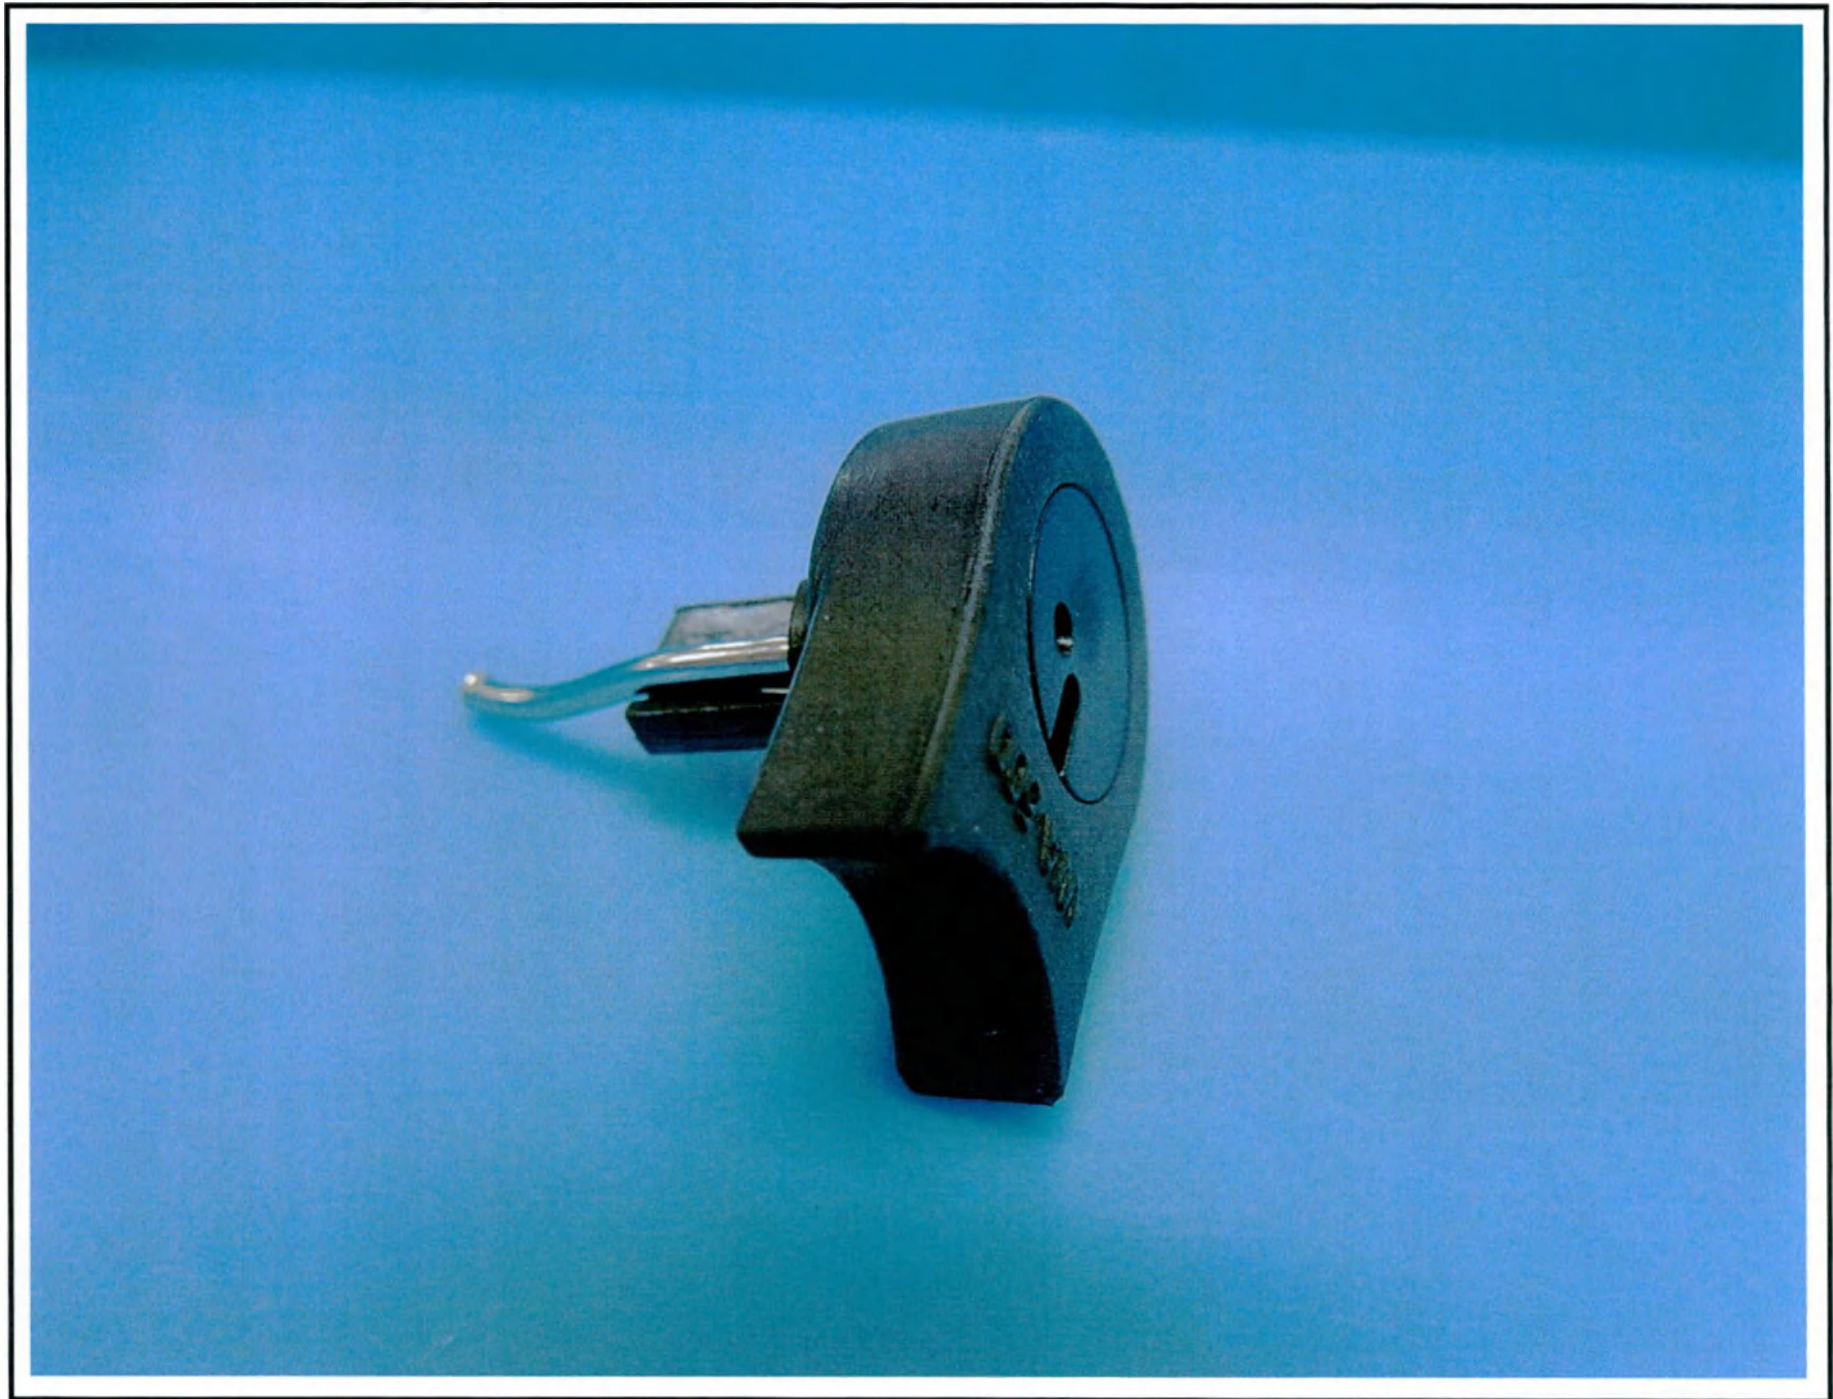


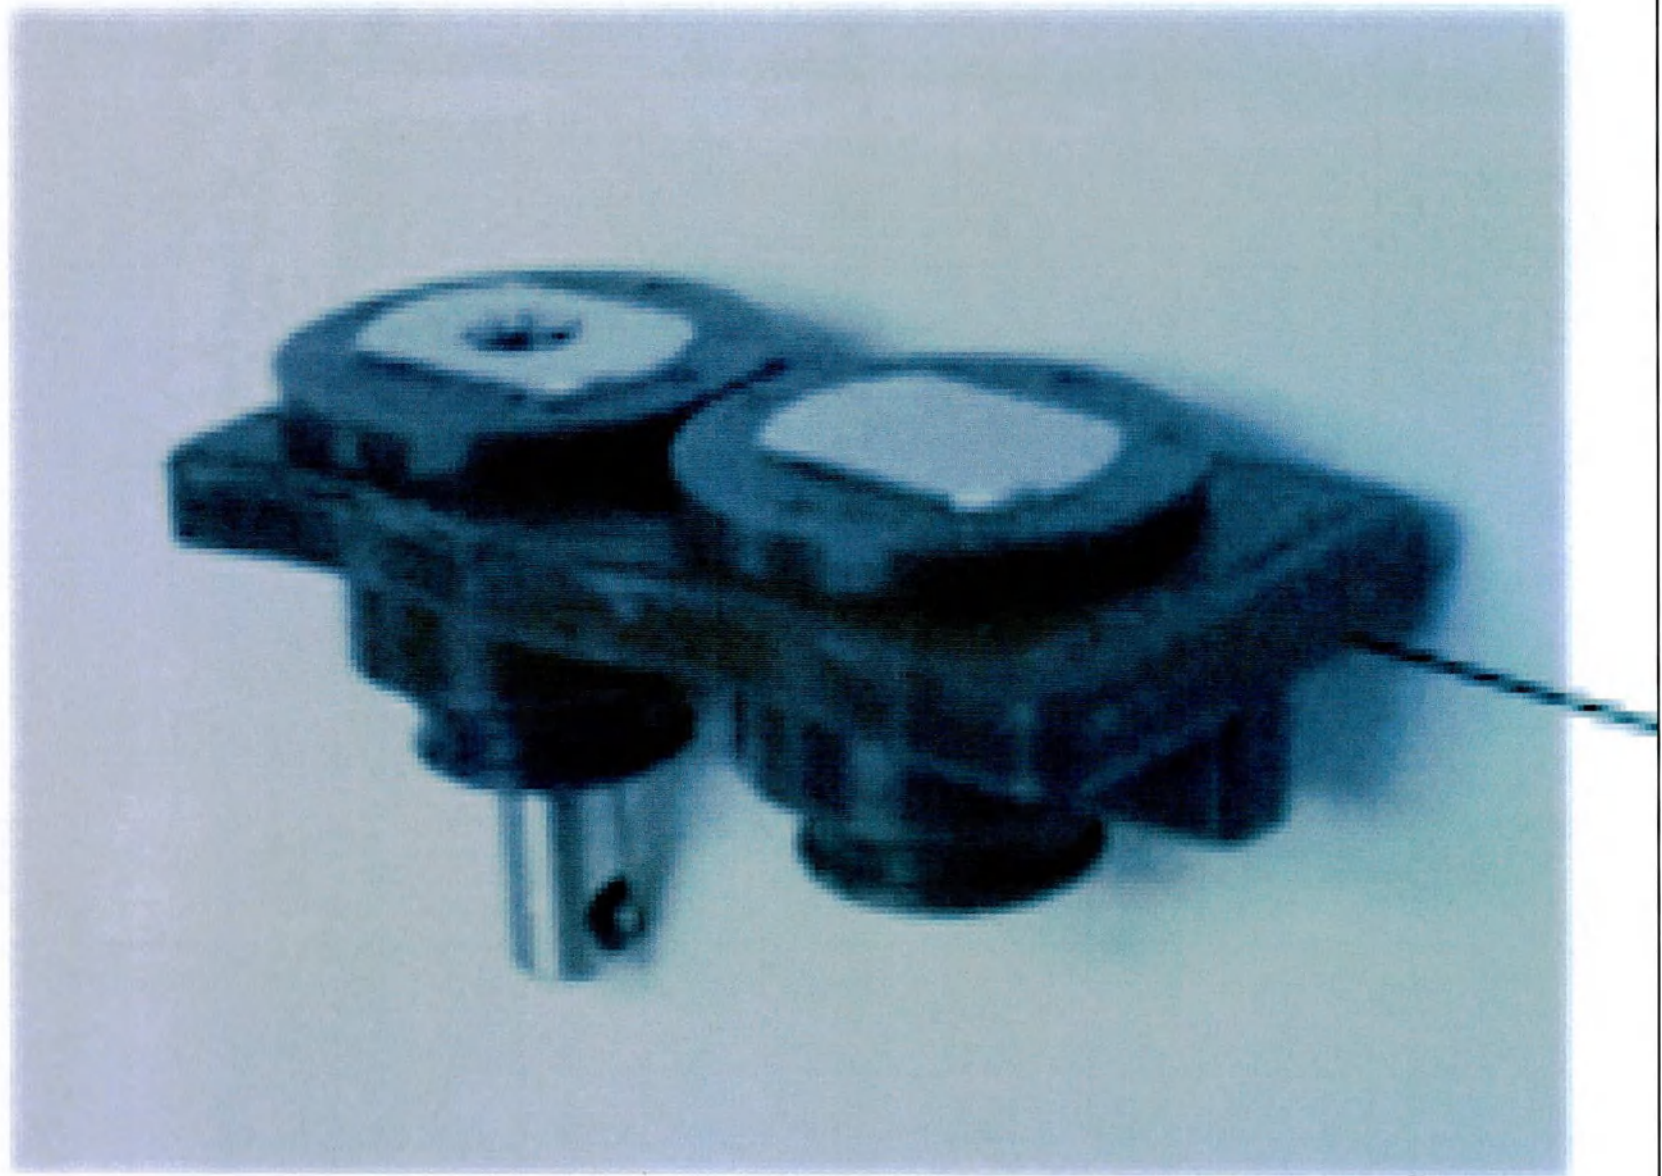





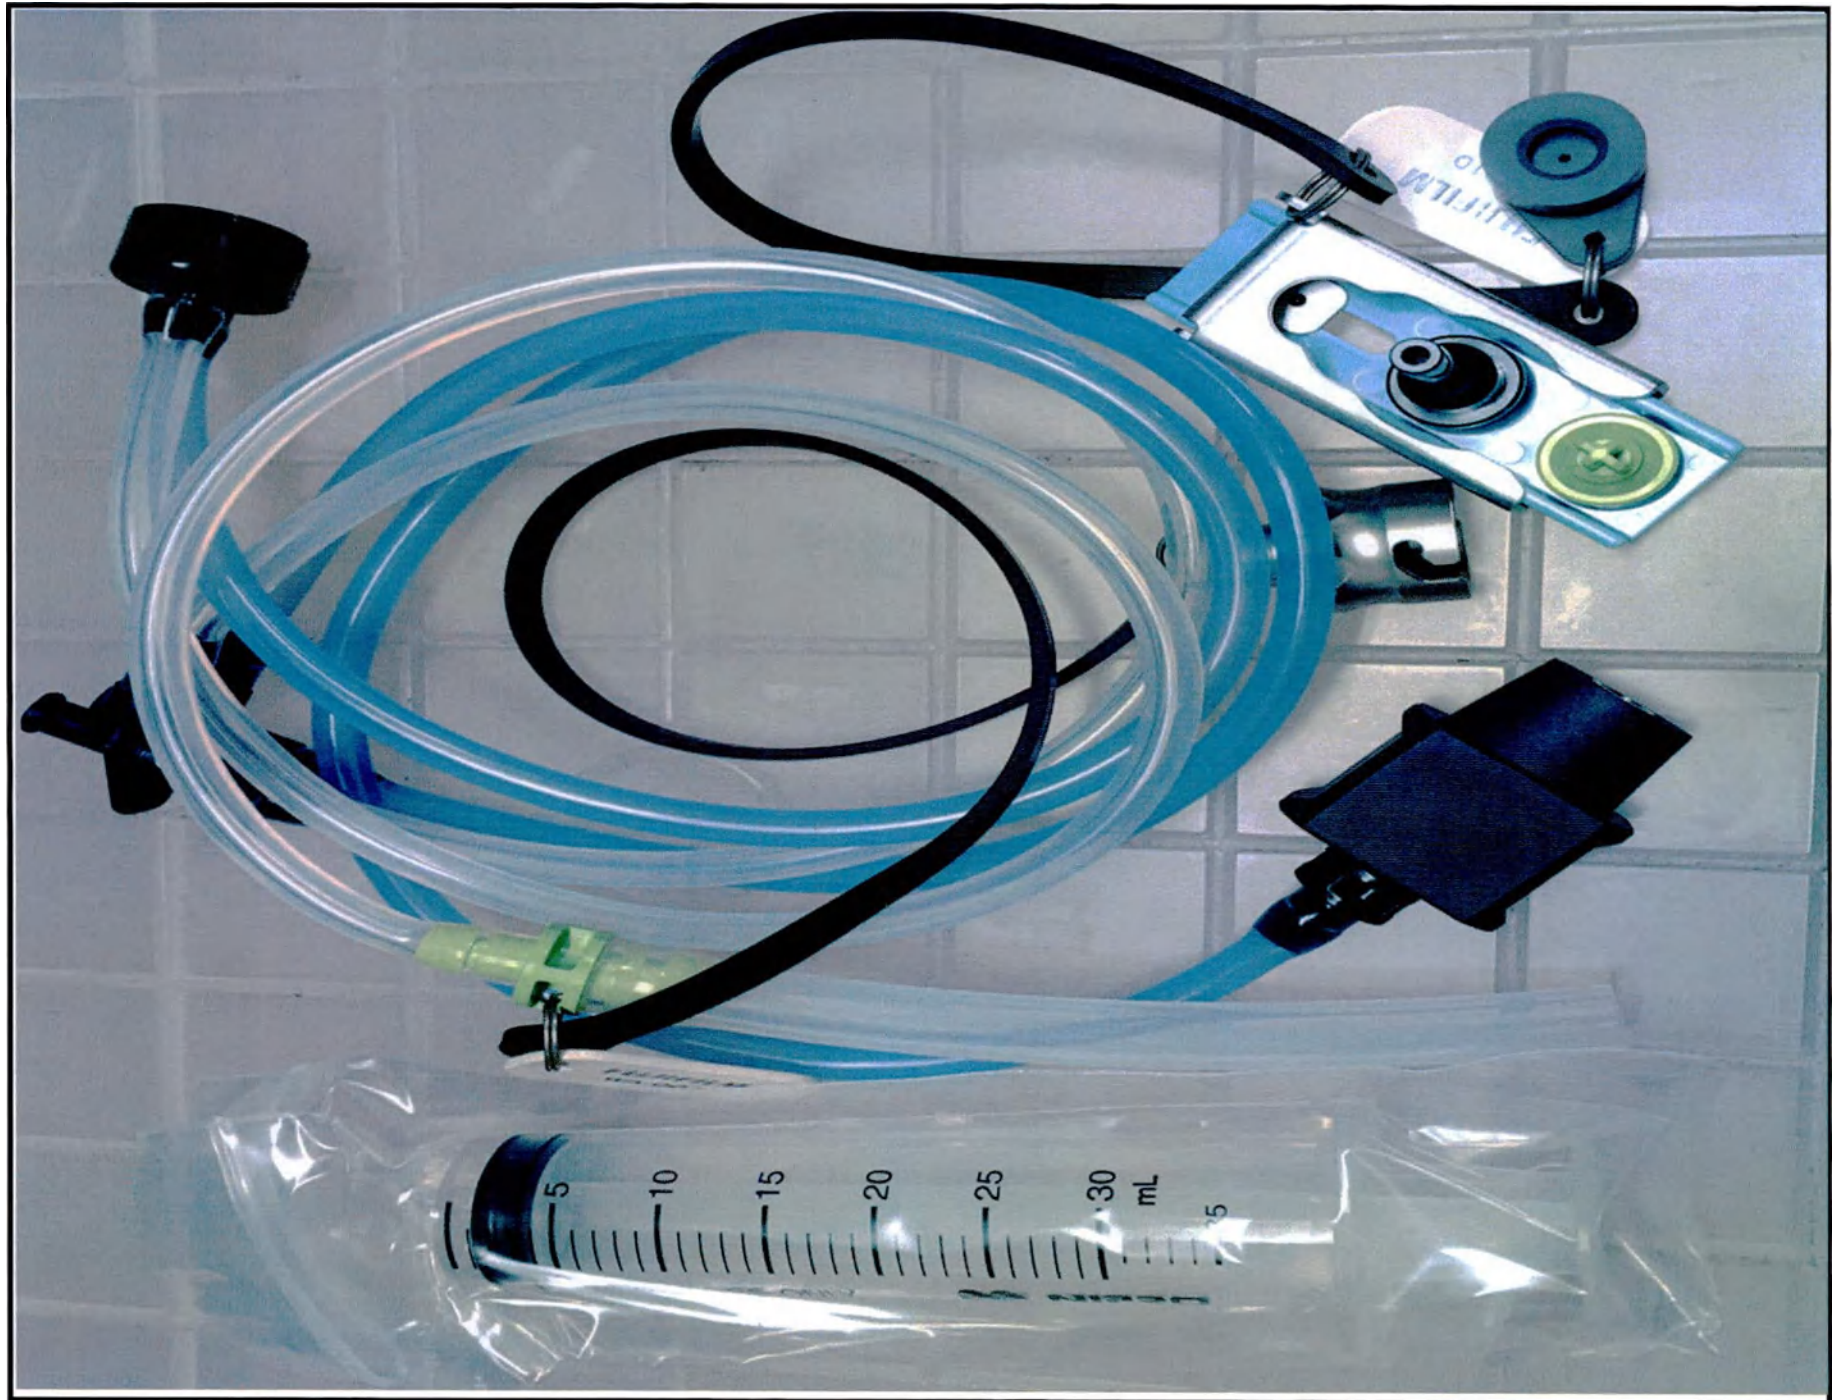





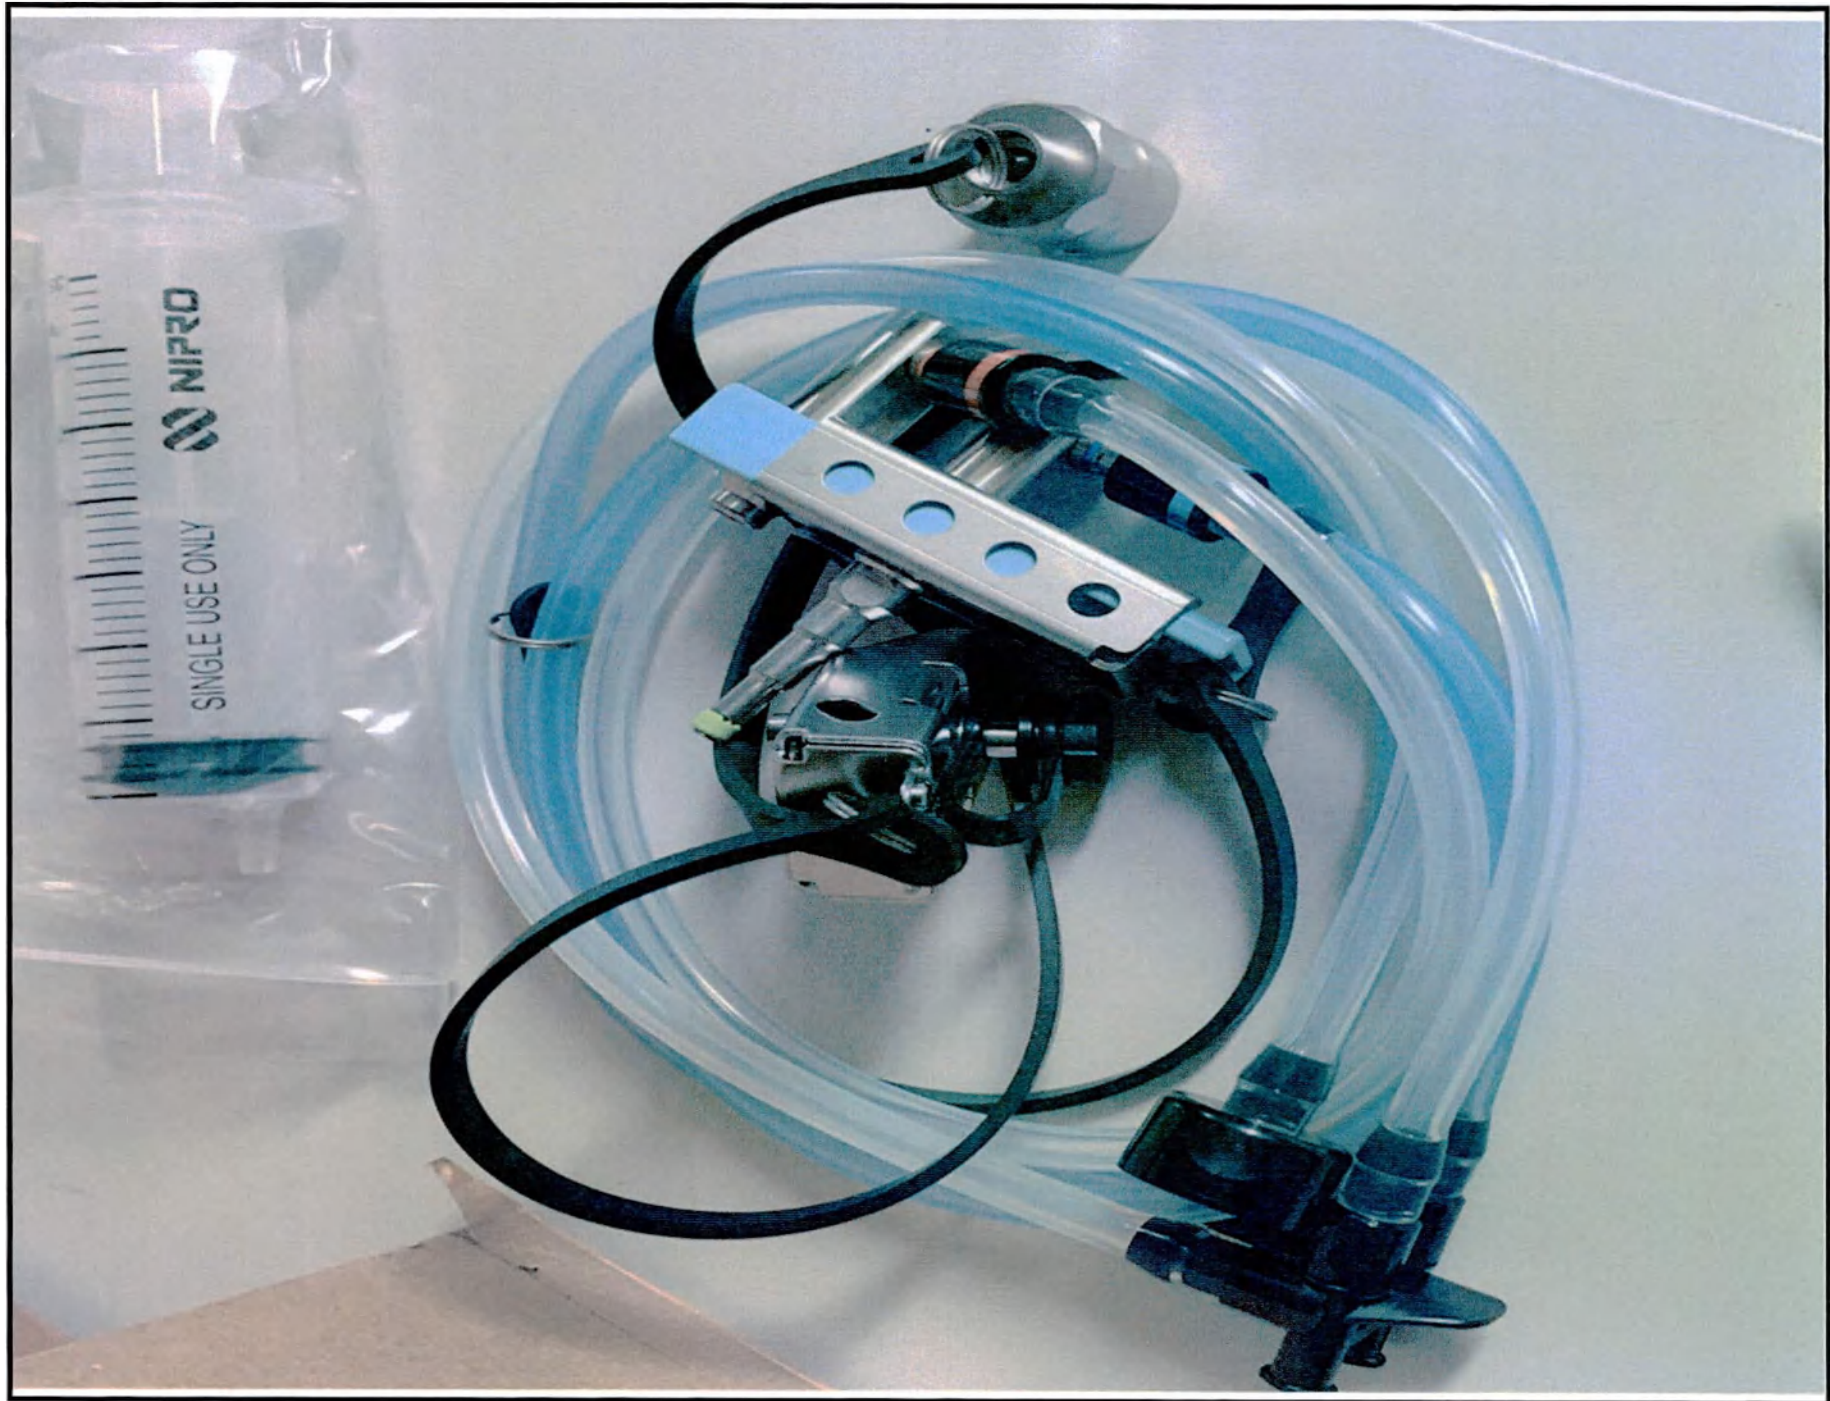

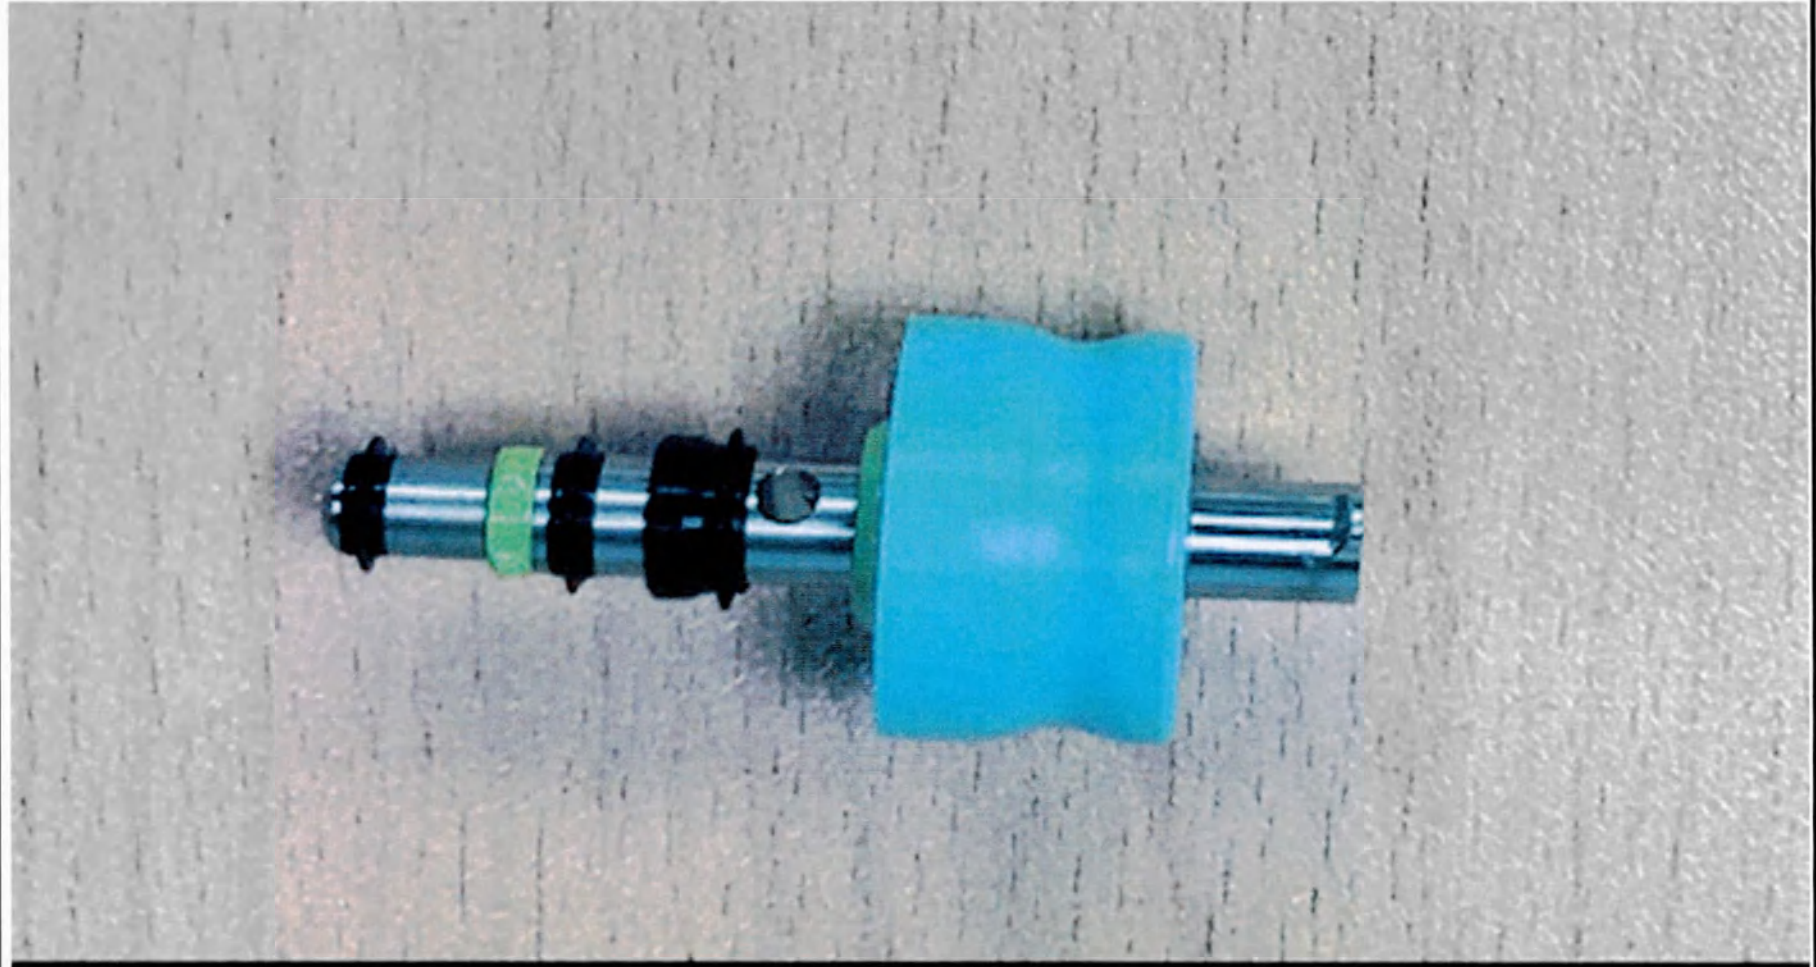


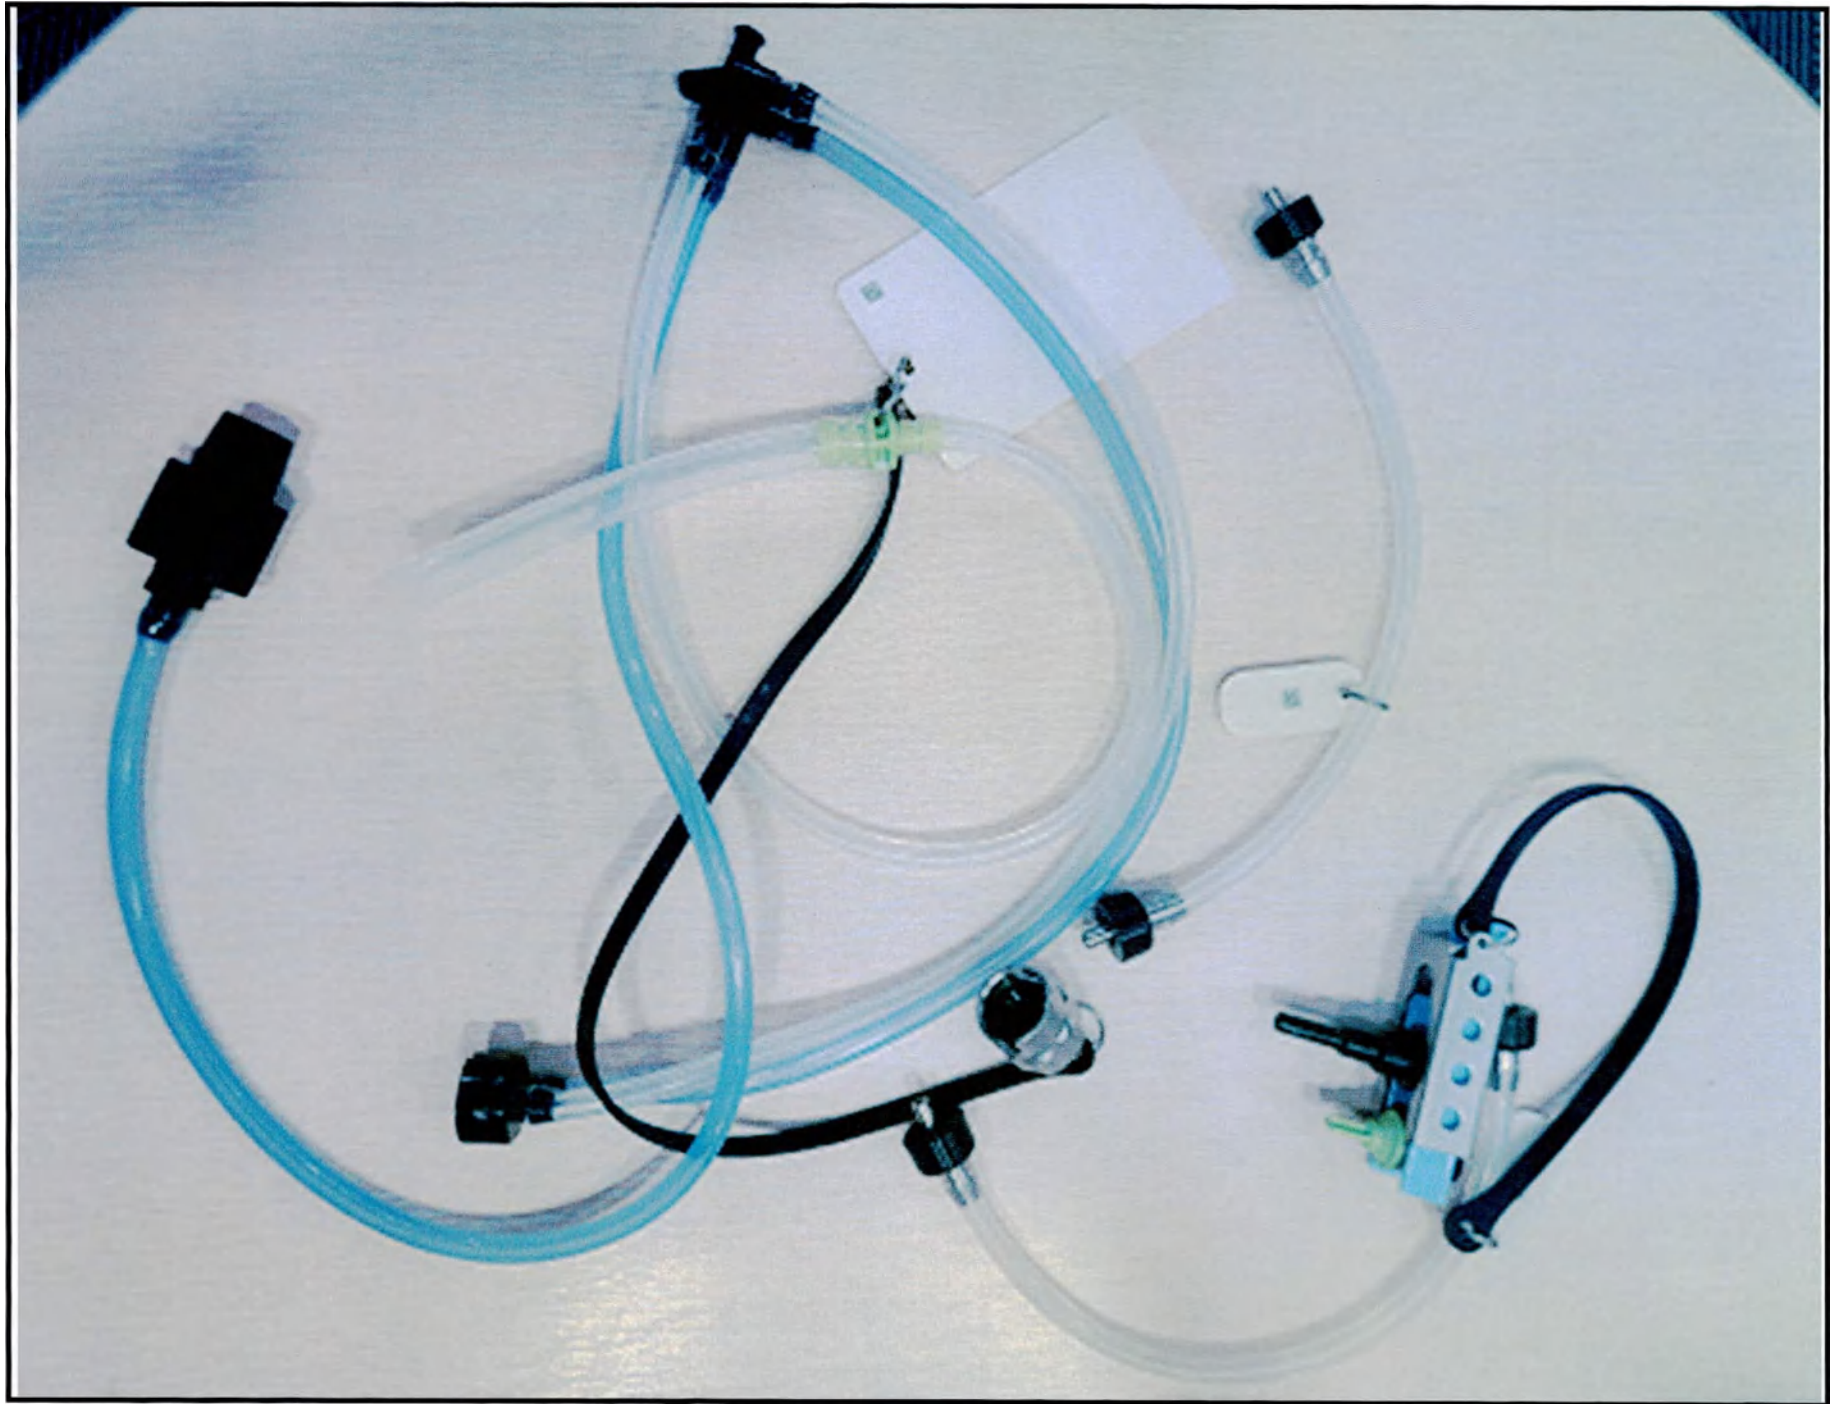

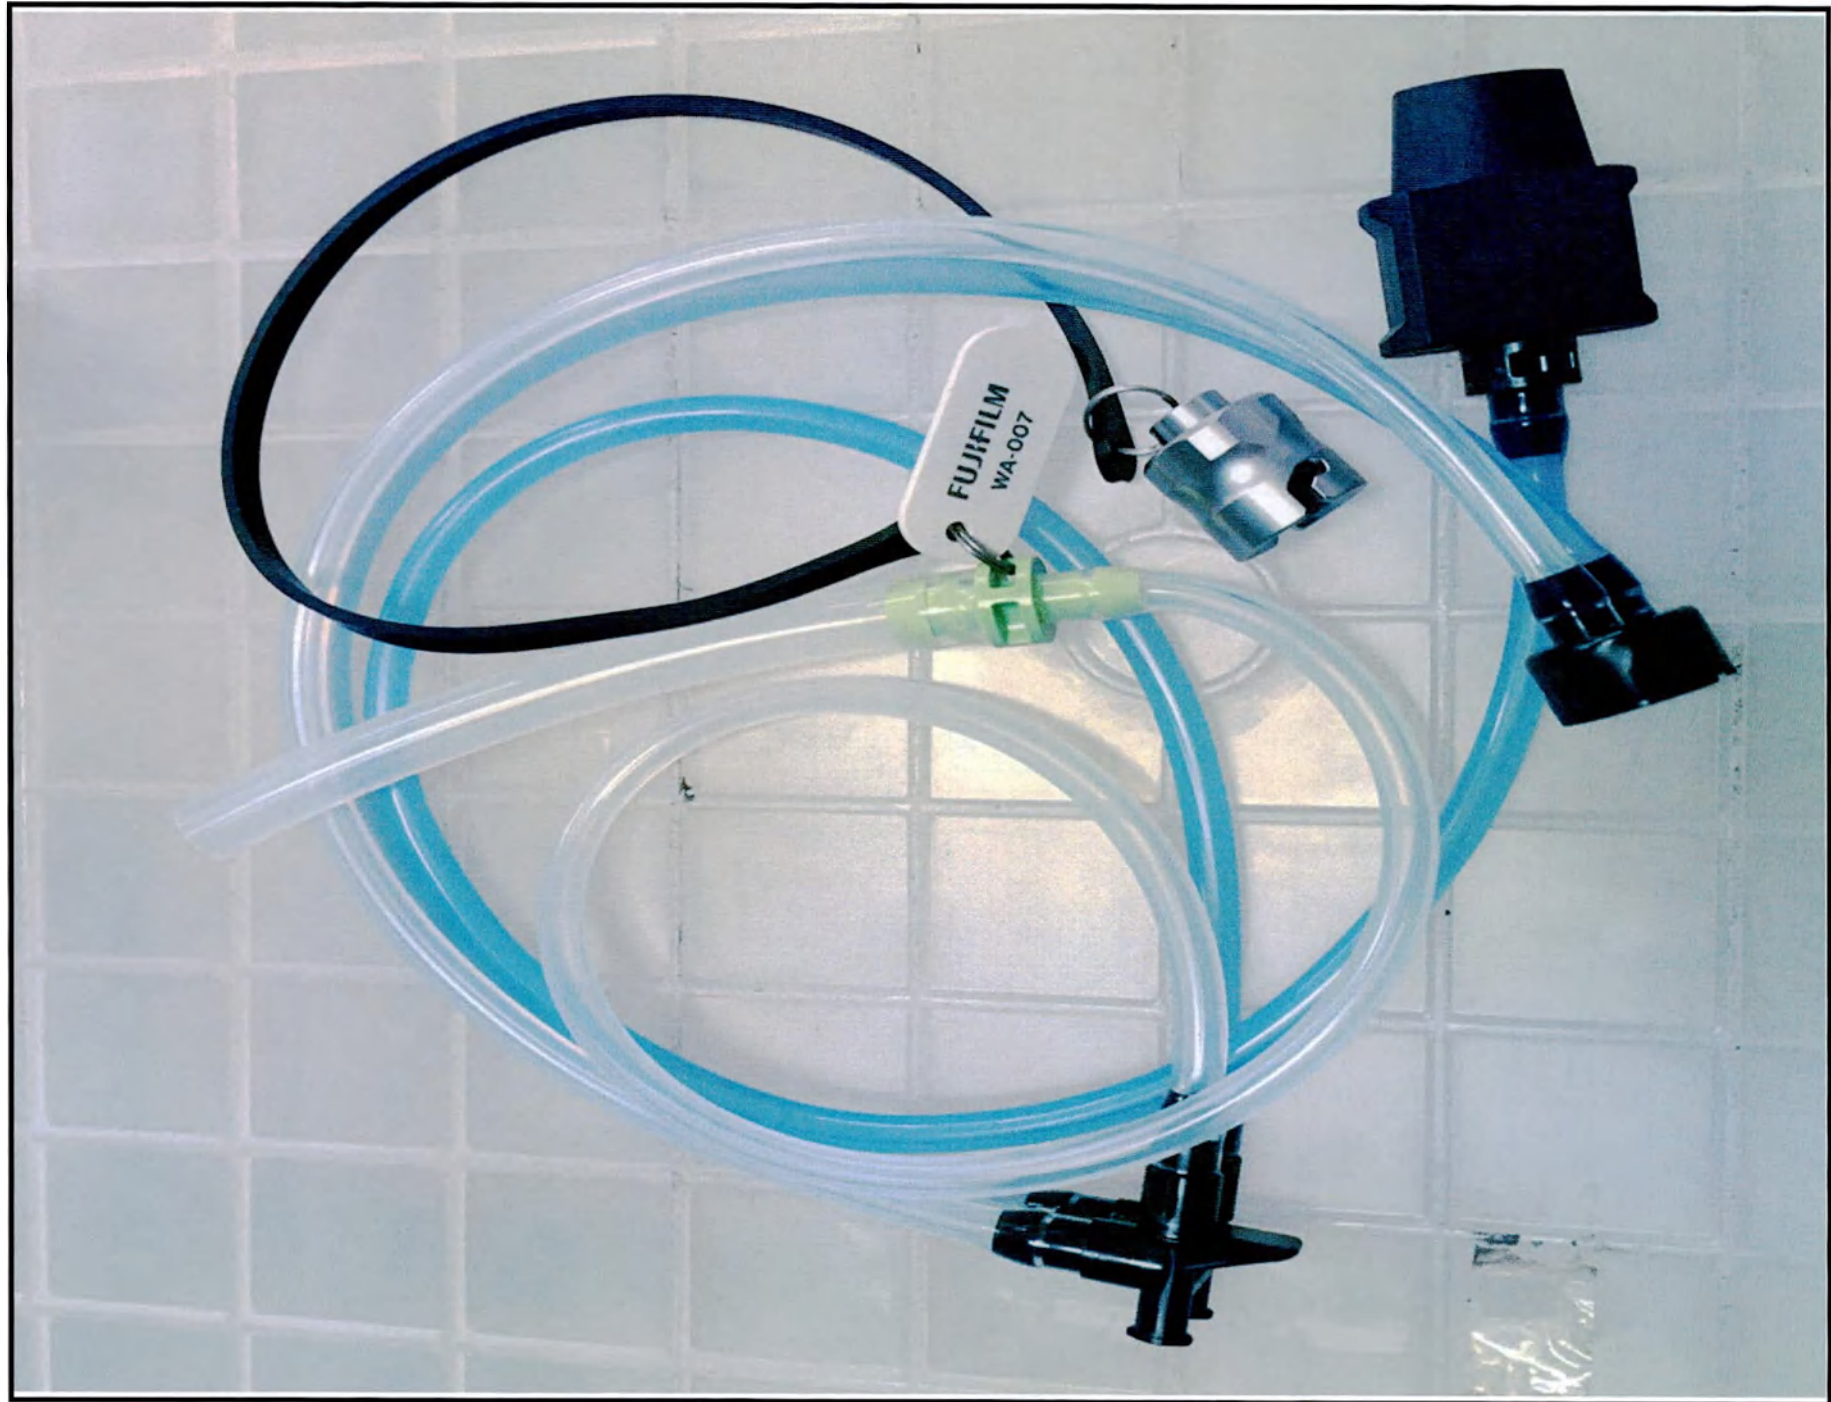

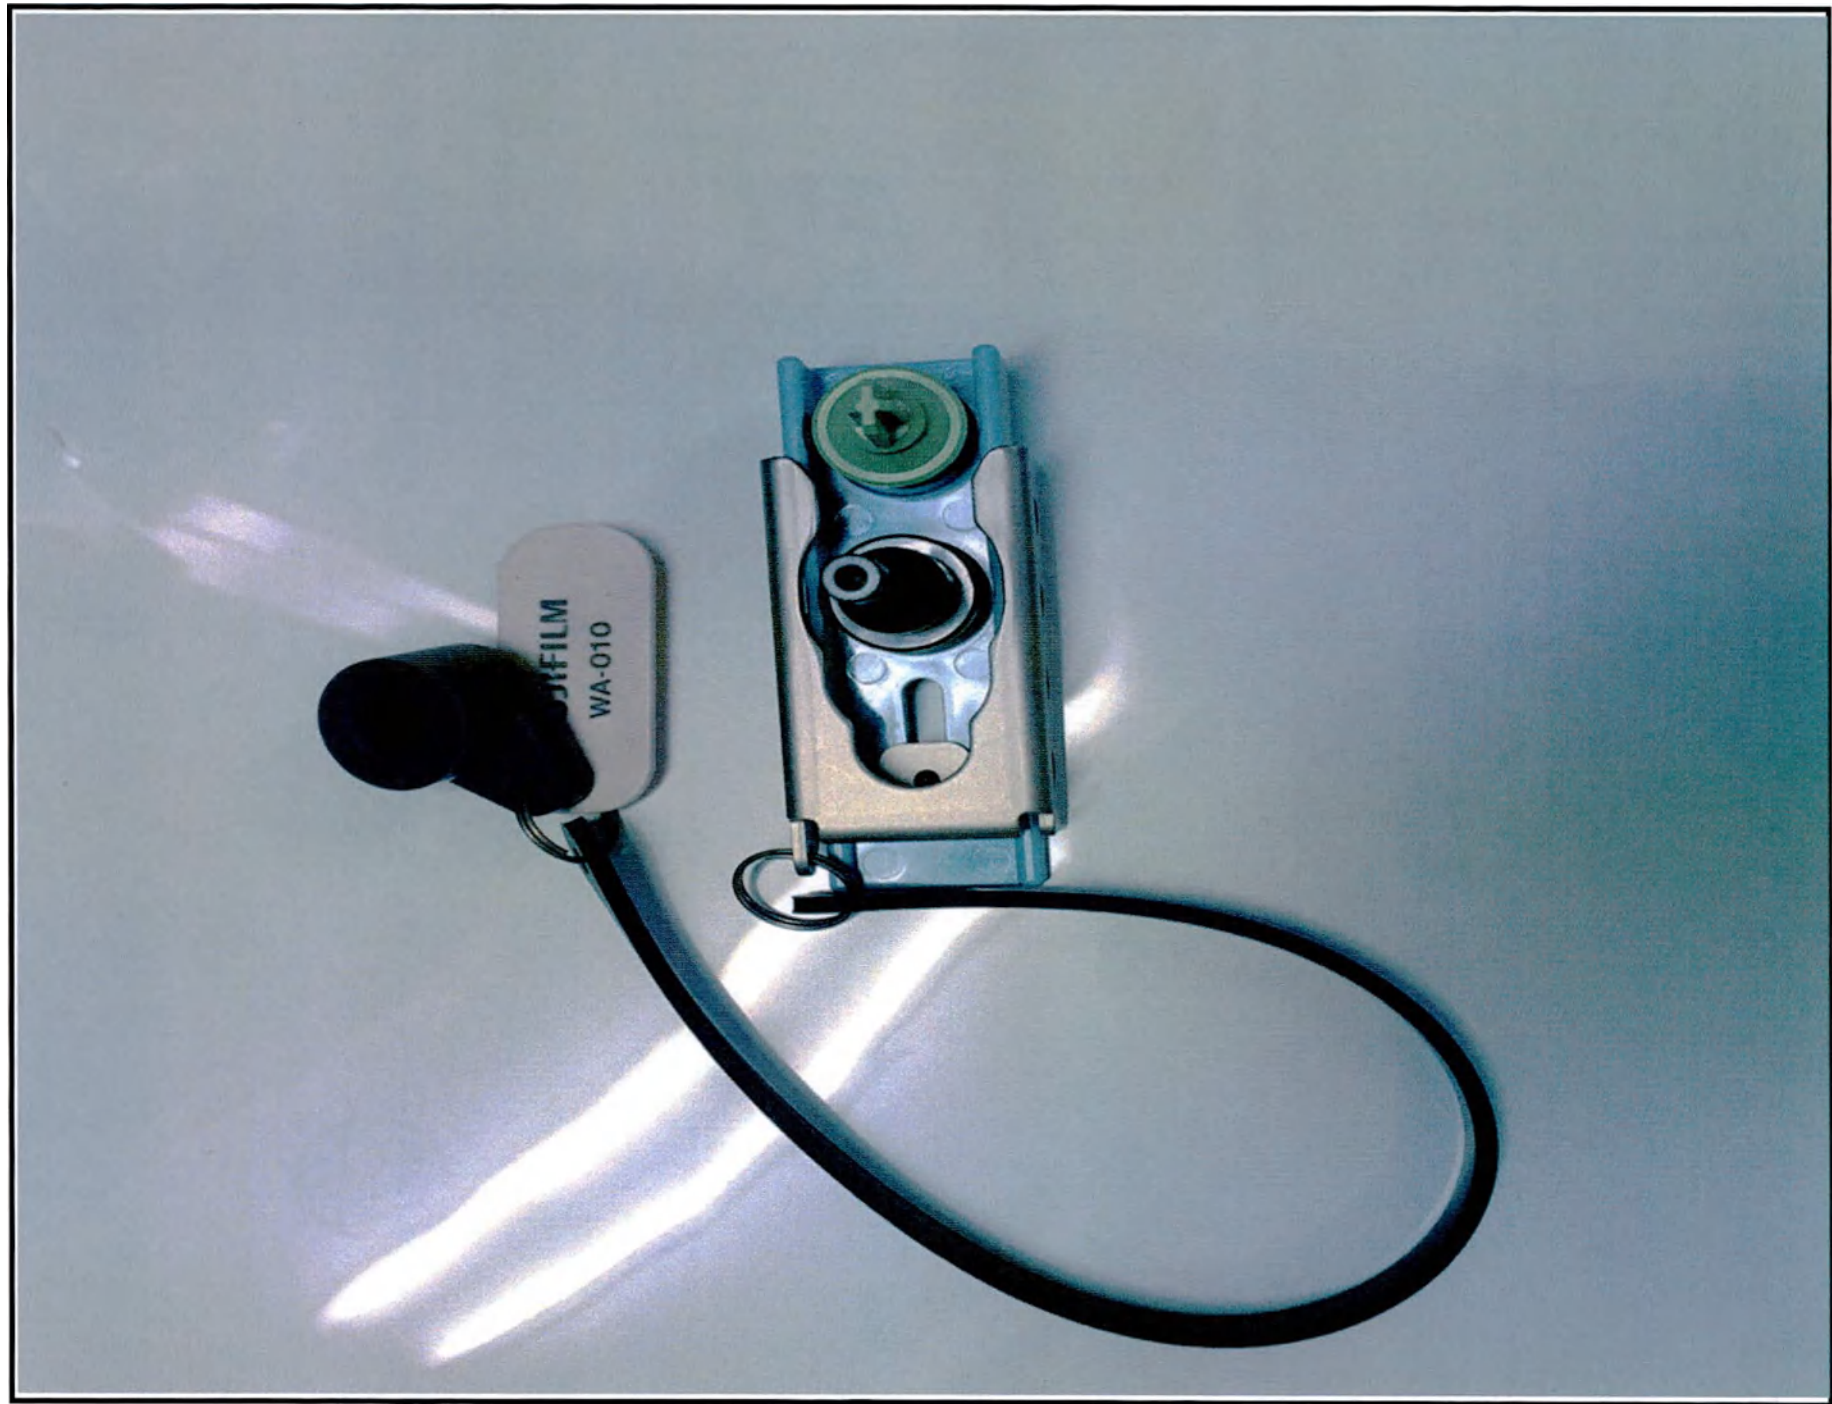




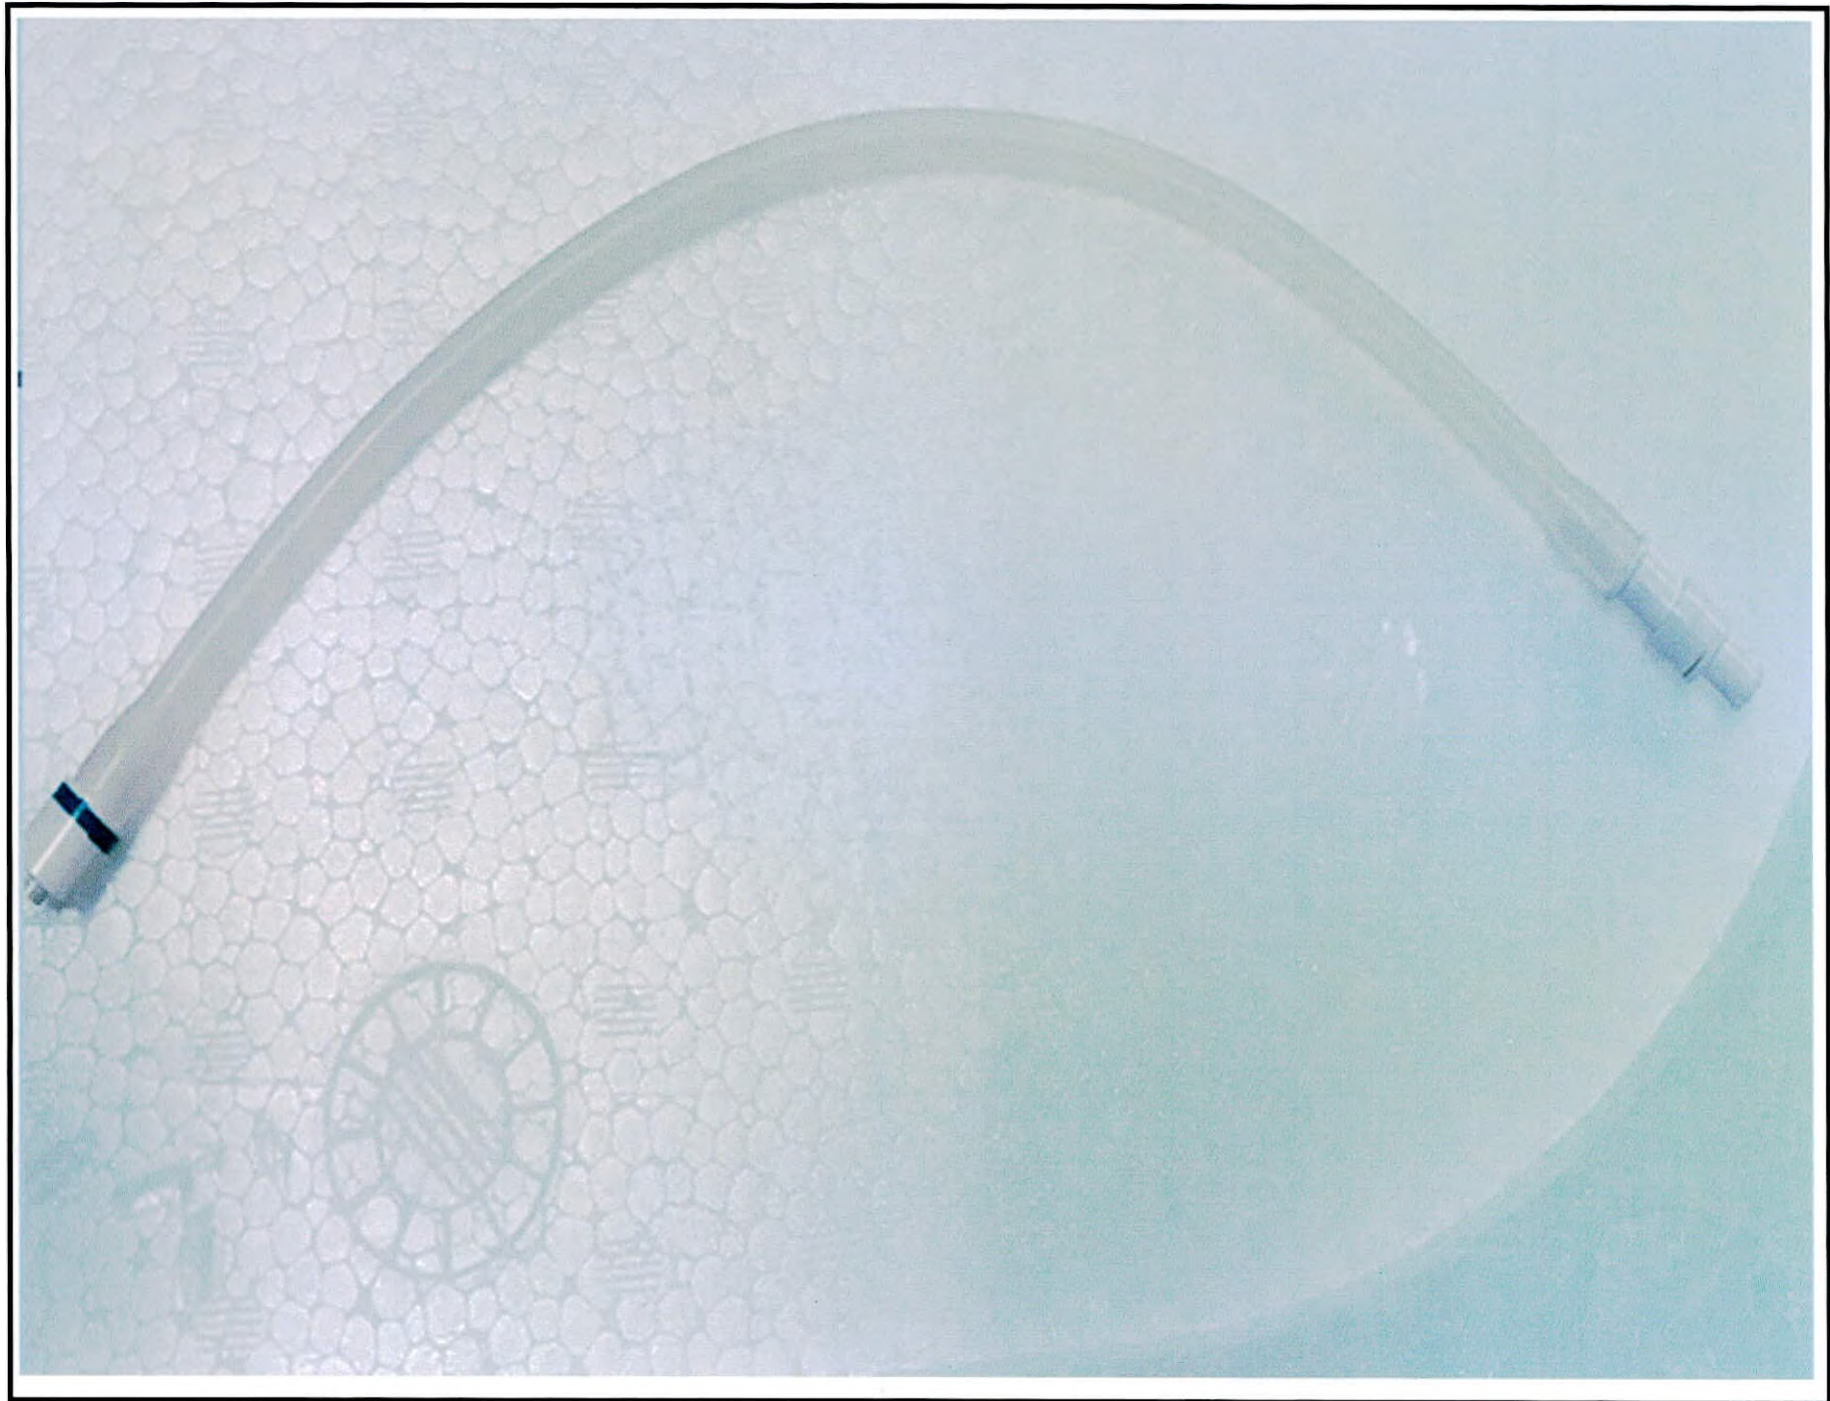

FUJIFILM

DH-33GR

Hood



en	Hood
de	Haube
fr	Capuchon
it	Cappuccio
es	Capuchón
pt	Proteção
nl	Kap
tr	Başlık

en : Maximum diameter with the Endoscope applied : 15.4mm
 de : Max. Durchmesser mit Endoskop : 15.4mm
 fr : Diamètre maximum avec l'endoscope appliqué : 15.4mm
 it : Diametro massimo con l'endoscopio applicato : 15.4mm
 es : Diámetro máximo con el endoscopio aplicado : 15.4mm
 pt : Diámetro máximo com o endoscópio aplicado : 15.4mm
 nl : Maximale diameter met bevestigde endoscoop : 15.4mm
 tr : Endoskopiya uygulandığı maksimum çap : 15.4mm

en : Distance from the tip : 7.0mm
de : Abstand von der Spitze : 7.0mm
fr : Distance de l'extrémité : 7.0mm
it : Distanza dalla punta : 7.0mm
es : Distancia de la punta : 7.0mm
pt : Distância a partir da ponta : 7.0mm
nl : Afstand vanaf het uiteinde : 7.0mm
tr : Uçtan mesafe : 7.0mm



STERILE	EO
---------	----



CE 0123



2024-12



2022-02

LOT 2201T2

MADE IN JAPAN
2202A8

5 pcs.



FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan



FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany

EU Importer :
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenaard 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by :
FUJIFILM Australia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW, 2100, Australia

DH-33GR
2201T2
FQ 87A
LN

Shipment use only








FUJIFILM

DH-40GR

Hood



en	Hood
de	Haube
fr	Capuchon
it	Cappuccio
es	Capuchón
pt	Proteção
nl	Kap
tr	Başlık

en : Maximum diameter with the Endoscope applied : 15.4mm
de : Max. Durchmesser mit Endoskop : 15.4mm
fr : Diamètre maximum avec l'endoscope appliqué : 15.4mm
es : Diámetro máximo con el endoscopio aplicado : 15.4mm
pt : Diâmetro máximo com o endoscópio aplicado : 15.4mm
nl : Maximale diameter met bevestigde endoscoop : 15.4mm
tr : Endoskopiya uygularken maksimum çap : 15.4mm

en : Distance from the tip : 8.3mm
de : Abstand von der Spitze : 8.3mm
fr : Distance de l'extrémité : 8.3mm
it : Distanza dalla punta : 8.3mm
es : Distancia de la punta : 8.3mm
pt : Distância a partir da ponta : 8.3mm
nl : Afstand vanaf het uiteinde : 8.3mm
tr : Uçtan mesafe : 8.3mm

5 pcs.



FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan



FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany



STERILE	EO
---------	----



CE 0123



2024-12



2022-01



2201S4

MADE IN JAPAN
2201C7

EU Importer :
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by:
FUJIFILM Australia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW. 2100, Australia

DH-40GR

2201S4

FQ 89A


LN



FUJIFILM

DH-40GR

Hood



en Hood
 de Haube
 fr Capuchon
 it Cappuccio
 es Capuchón
 pt Proteção
 nl Kap
 tr Başlık

en: Maximum diameter with the Endoscope applied: 15.4mm
 de: Max. Durchmesser mit Endoskop: 15.4mm
 fr: Diamètre maximum avec l'endoscope appliqué: 15.4mm
 it: Diametro massimo con l'endoscopio applicato: 15.4mm
 es: Diámetro máximo con el endoscopio aplicado: 15.4mm
 pt: Diâmetro máximo com o endoscópio aplicado: 15.4mm
 nl: Maximale diameter met bevestigde endoscoop: 15.4mm
 tr: Endoskopa uygulanmış maksimum çap: 15.4mm

en: Distance from the tip: 8.3mm
 de: Abstand von der Spitze: 8.3mm
 fr: Distance de l'extrémité: 8.3mm
 it: Distanza dalla punta: 8.3mm
 es: Distancia de la punta: 8.3mm
 pt: Distância a partir da ponta: 8.3mm
 nl: Afstand vanaf het uiteinde: 8.3mm
 tr: Uçtan mesafe: 8.3mm

FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
 Tokyo 106-8620, Japan

FUJIFILM Europe GmbH
 Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany



STERILE EO



CE 0123



2024-12

2022-01

LOT 2201S4

MADE IN JAPAN
 2201C7

PATIENT CHART	Hood	DH-40GR	FUJIFILM
	Steriz. Lot:	2201S4	
INVENTORY CONTROL	Use by:	2024-12	
	Hood	DH-40GR	FUJIFILM
PATIENT CHARGE	Steriz. Lot:	2201S4	
	Use by:	2024-12	
PATIENT CHARGE	Hood	DH-40GR	FUJIFILM
	Steriz. Lot:	2201S4	
PATIENT CHARGE	Use by:	2024-12	


GS1-128




(01) 04547410395204 (17) 241200 (10) 2201S4
 DH-40GR FQ69A PT-0





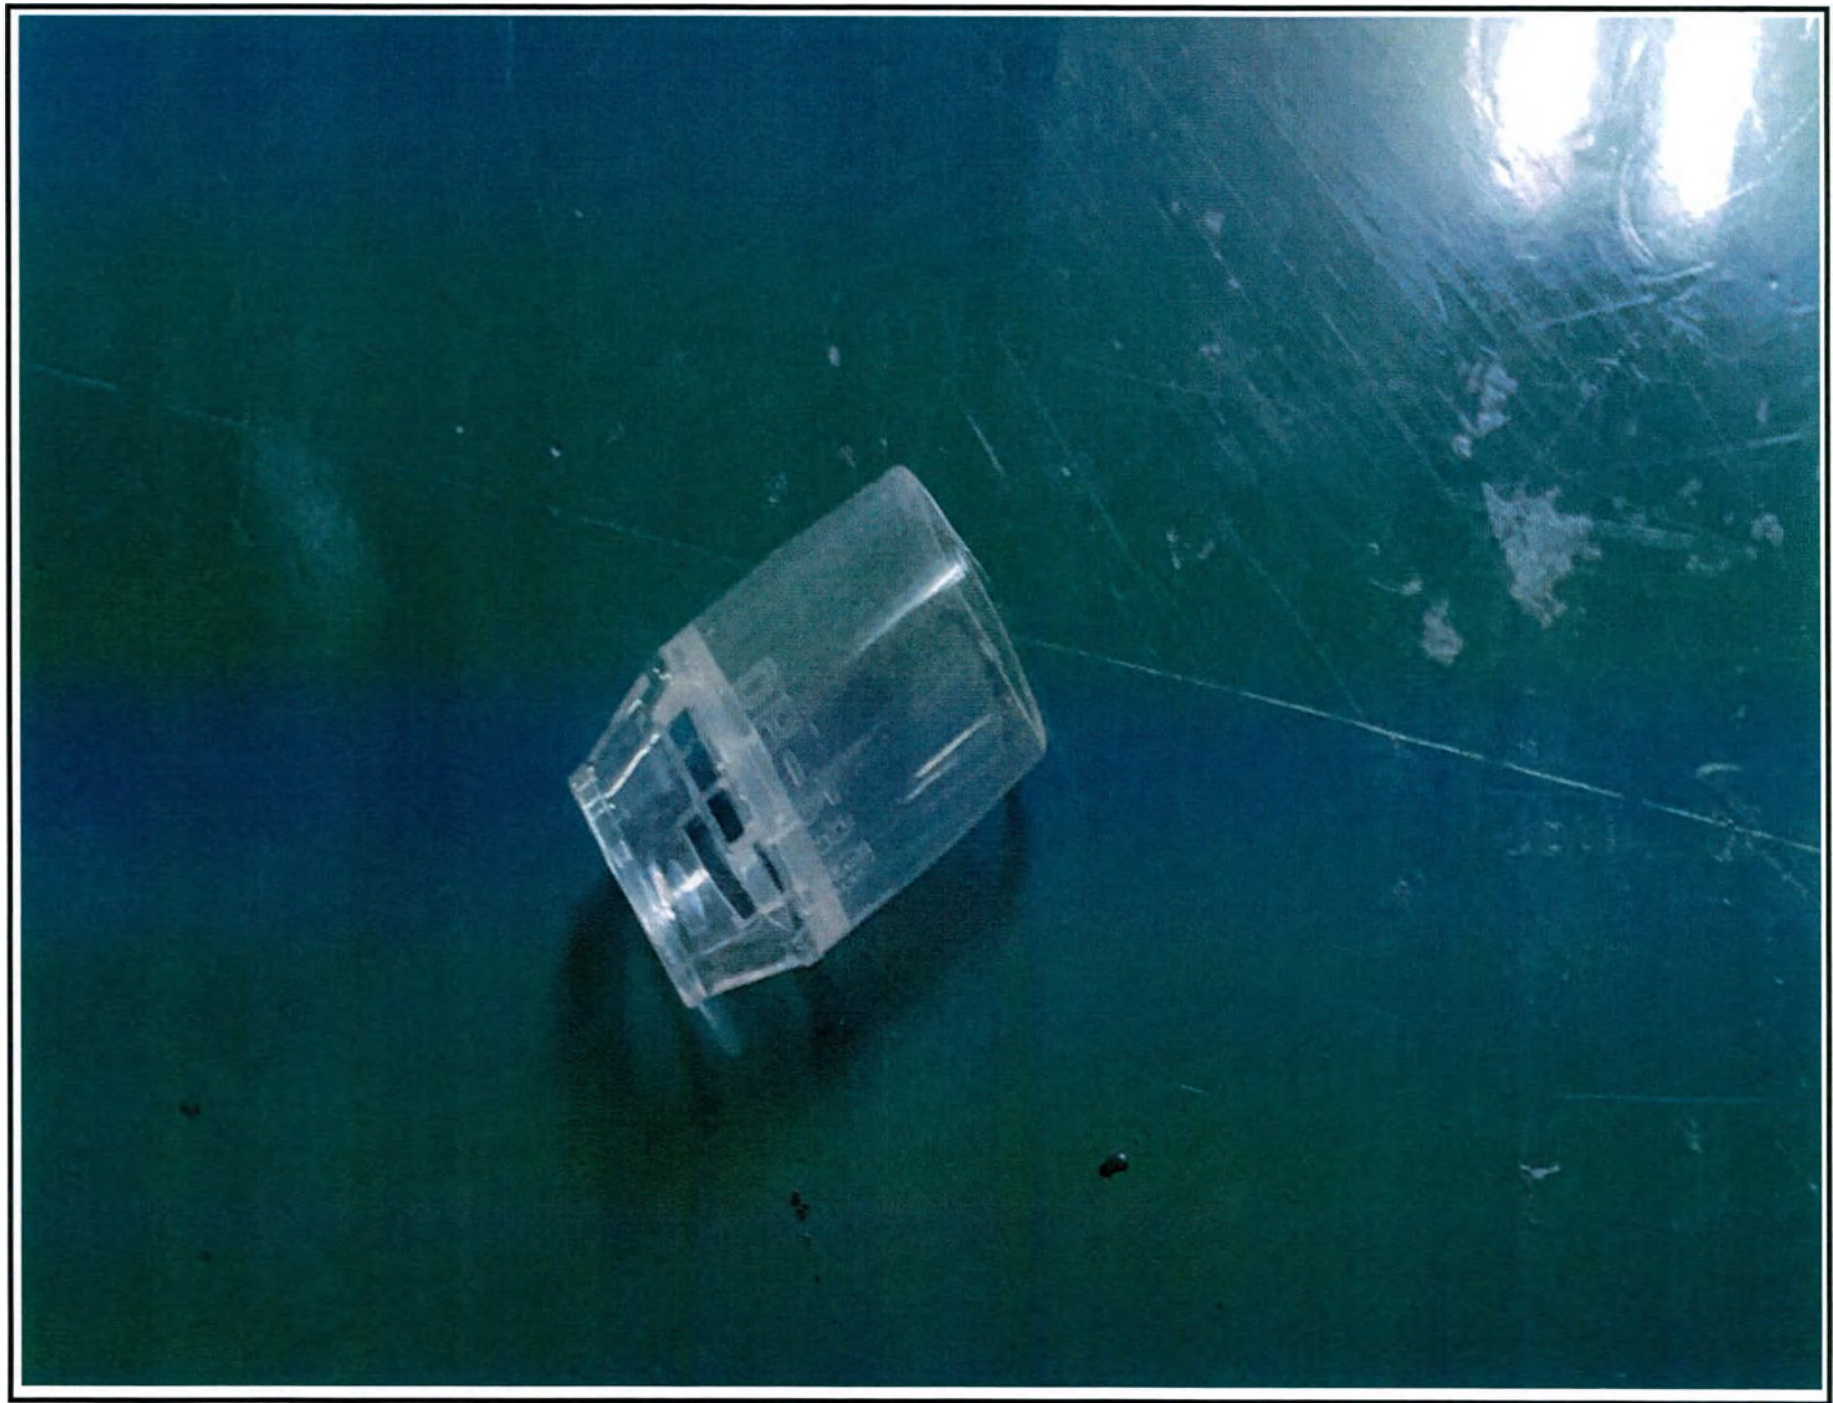


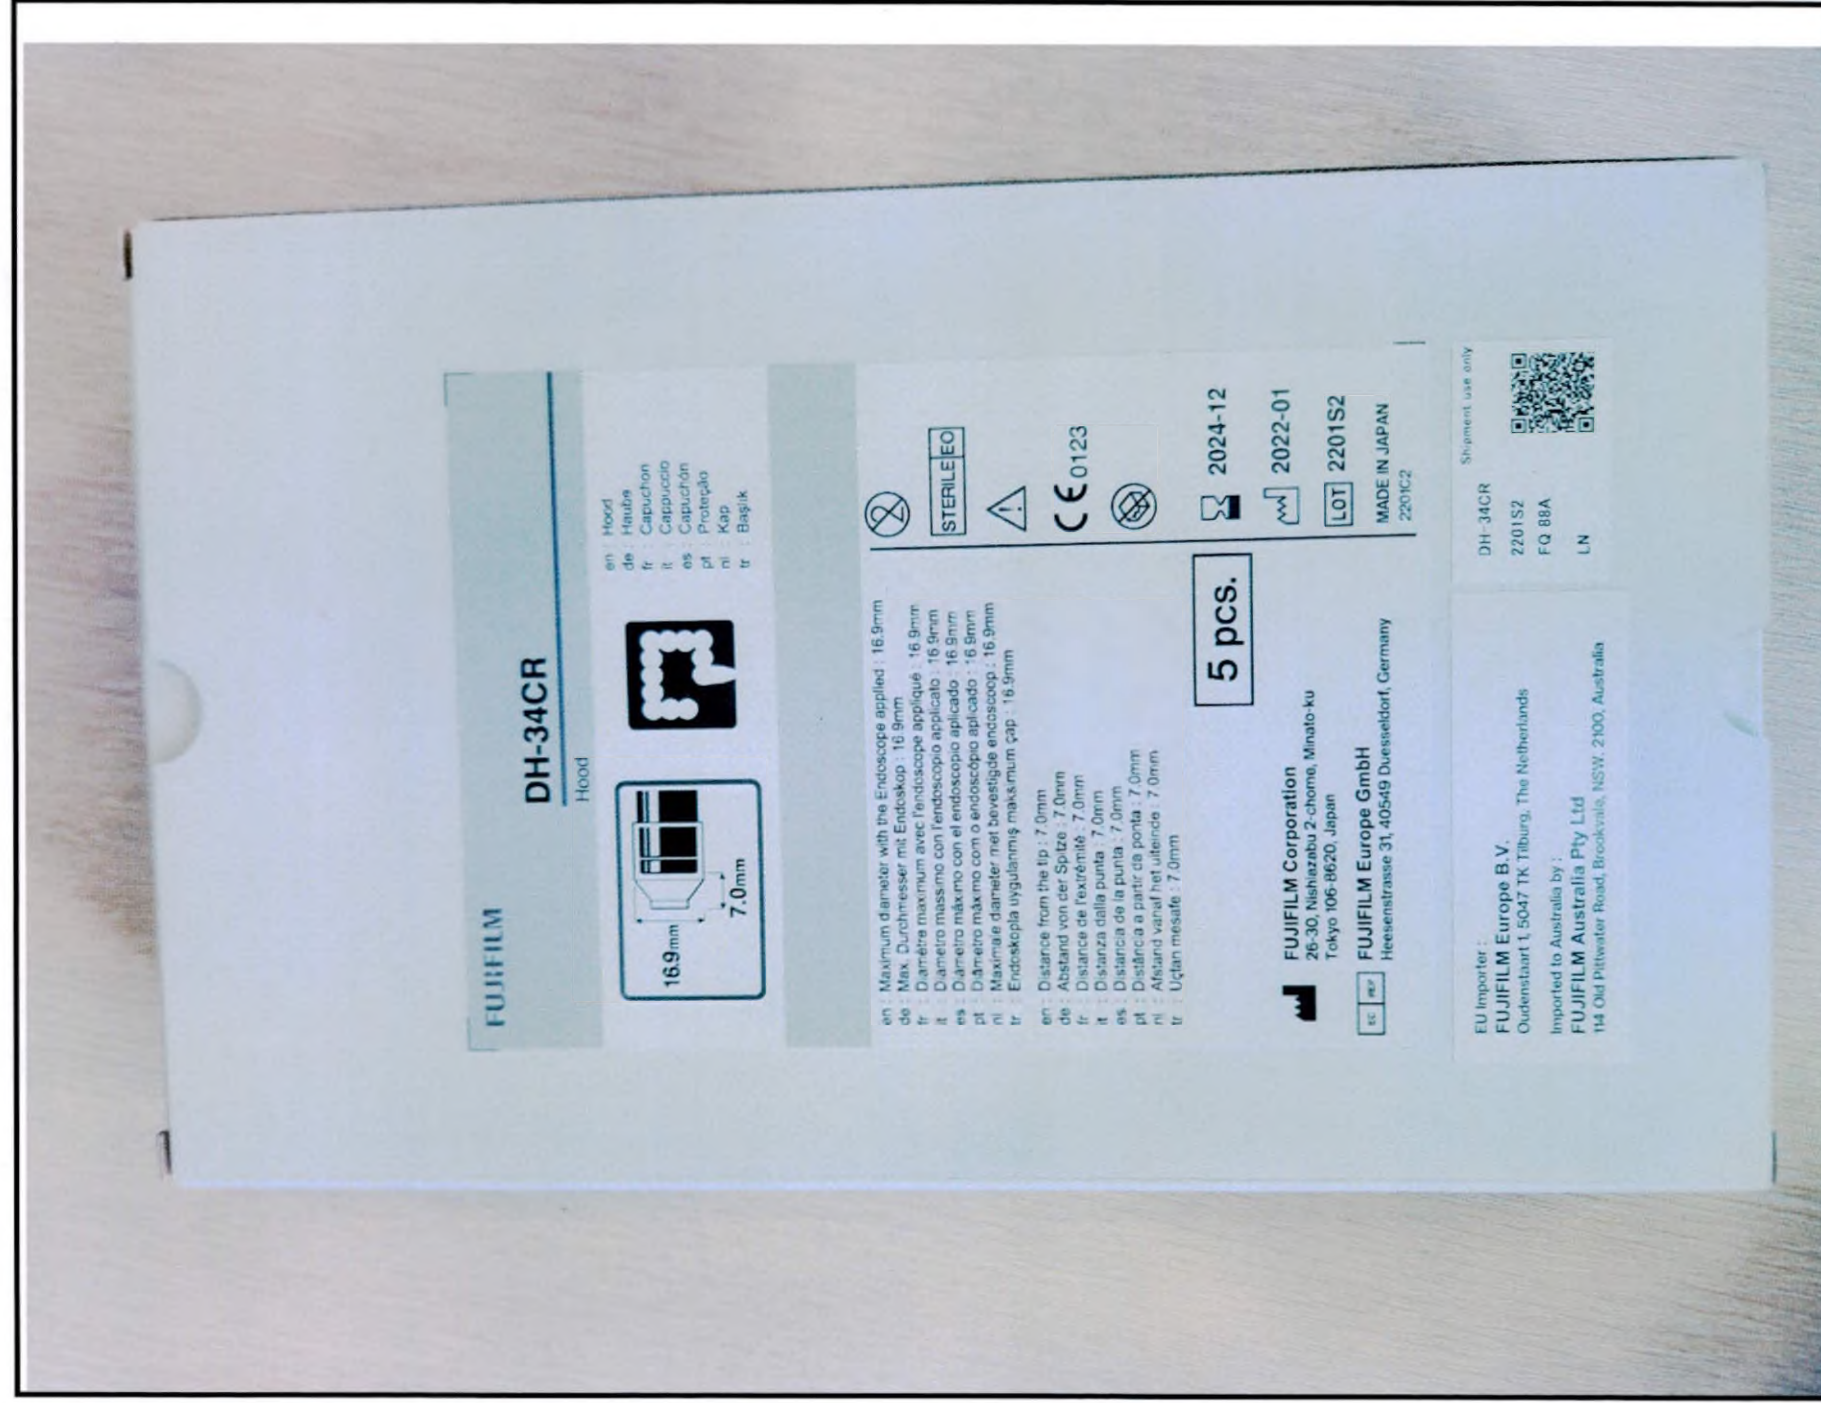

FUJIFILM

DH-34CR

Hood



en Hood
de Haube
fr Capuchon
it Cappuccio
es Capuchón
pt Proteção
nl Kap
tr Başlık

en Maximum diameter with the Endoscope applied : 16.9mm
de Max. Durchmesser mit Endoskop : 16.9mm
fr Diamètre maximum avec l'endoscope appliqué : 16.9mm
it Diametro massimo con l'endoscopio applicato : 16.9mm
es Diametro máximo con el endoscopio aplicado : 16.9mm
pt Diâmetro máximo com o endoscópio aplicado : 16.9mm
nl Maximale diameter met bevestigde endoscoop : 16.9mm
tr Endoskopa uygulanmış maksimum çap : 16.9mm

en Distance from the tip : 7.0mm
de Abstand von der Spitze : 7.0mm
fr Distance de l'extrémité : 7.0mm
it Distanza dalla punta : 7.0mm
es Distancia de la punta : 7.0mm
pt Distância a partir da ponta : 7.0mm
nl Afstand vanaf het uiteinde : 7.0mm
tr Uçtan mesafe : 7.0mm



STERILE EO



CE 0123



2024-12

2022-01

LOT 2201S2

MADE IN JAPAN
2201C2



FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan



FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany

PATIENT CHART	Hood DH-34CR Steriz. Lot : 2201S2 Use by : 2024-12	FUJIFILM
INVENTORY CONTROL	Hood DH-34CR Steriz. Lot : 2201S2 Use by : 2024-12	FUJIFILM
PATIENT CHARGE	Hood DH-34CR Steriz. Lot : 2201S2 Use by : 2024-12	FUJIFILM

GS1-128





(01) 04547410395198 (17) 241200 (10) 2201S2


DH-34CR FQ88A PI-0

12. Кошачья дистанция для эндоскопов (3 шт./уп.), в исполнении: ДП-330К, ДП-400К, ДП-450К, ДП-500К, ДП-540К¹⁰⁰
Вариант исполнения: ДН-34СР.




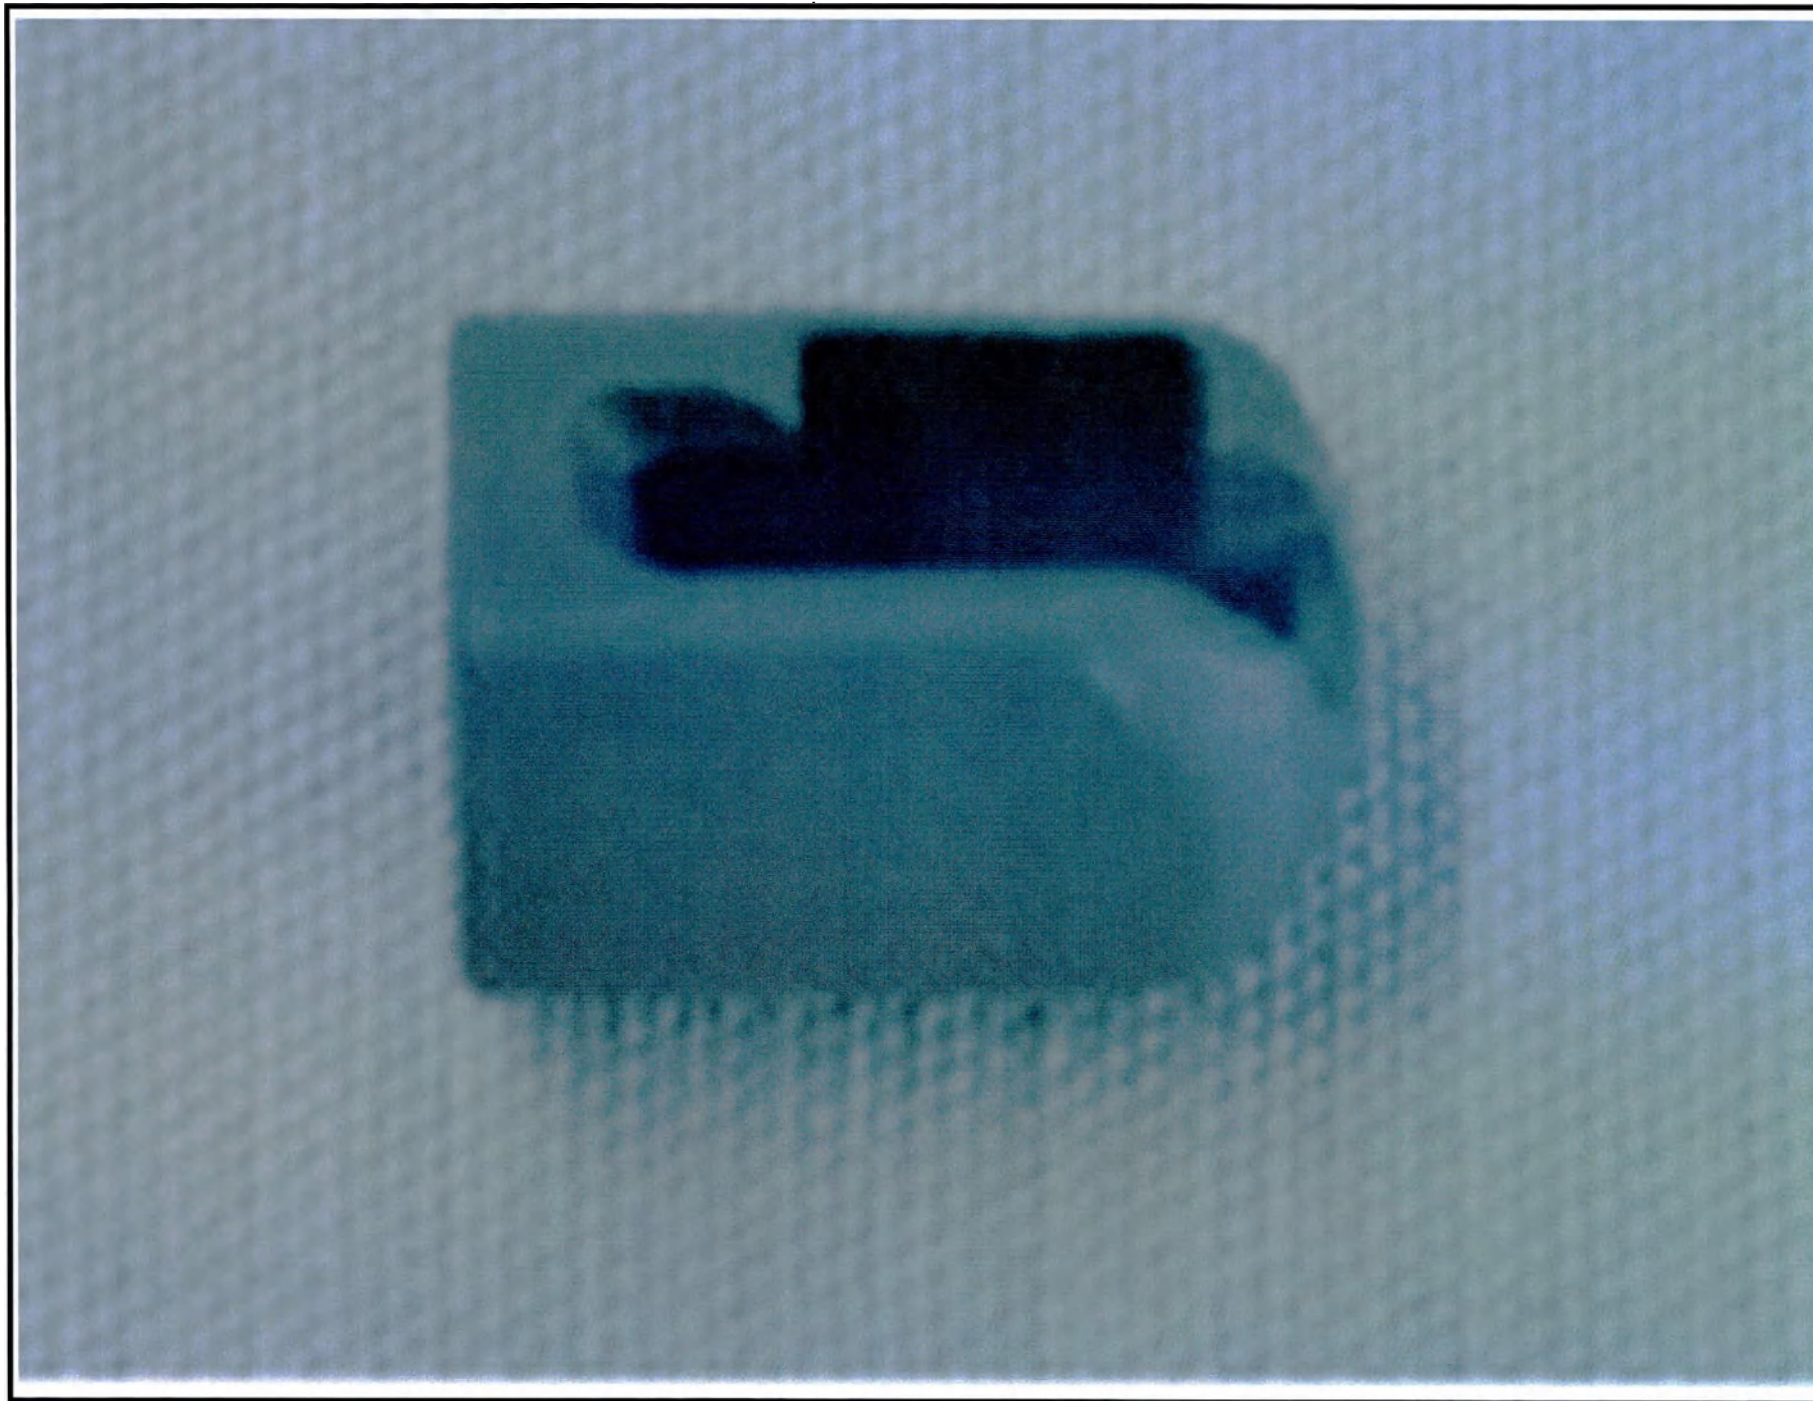


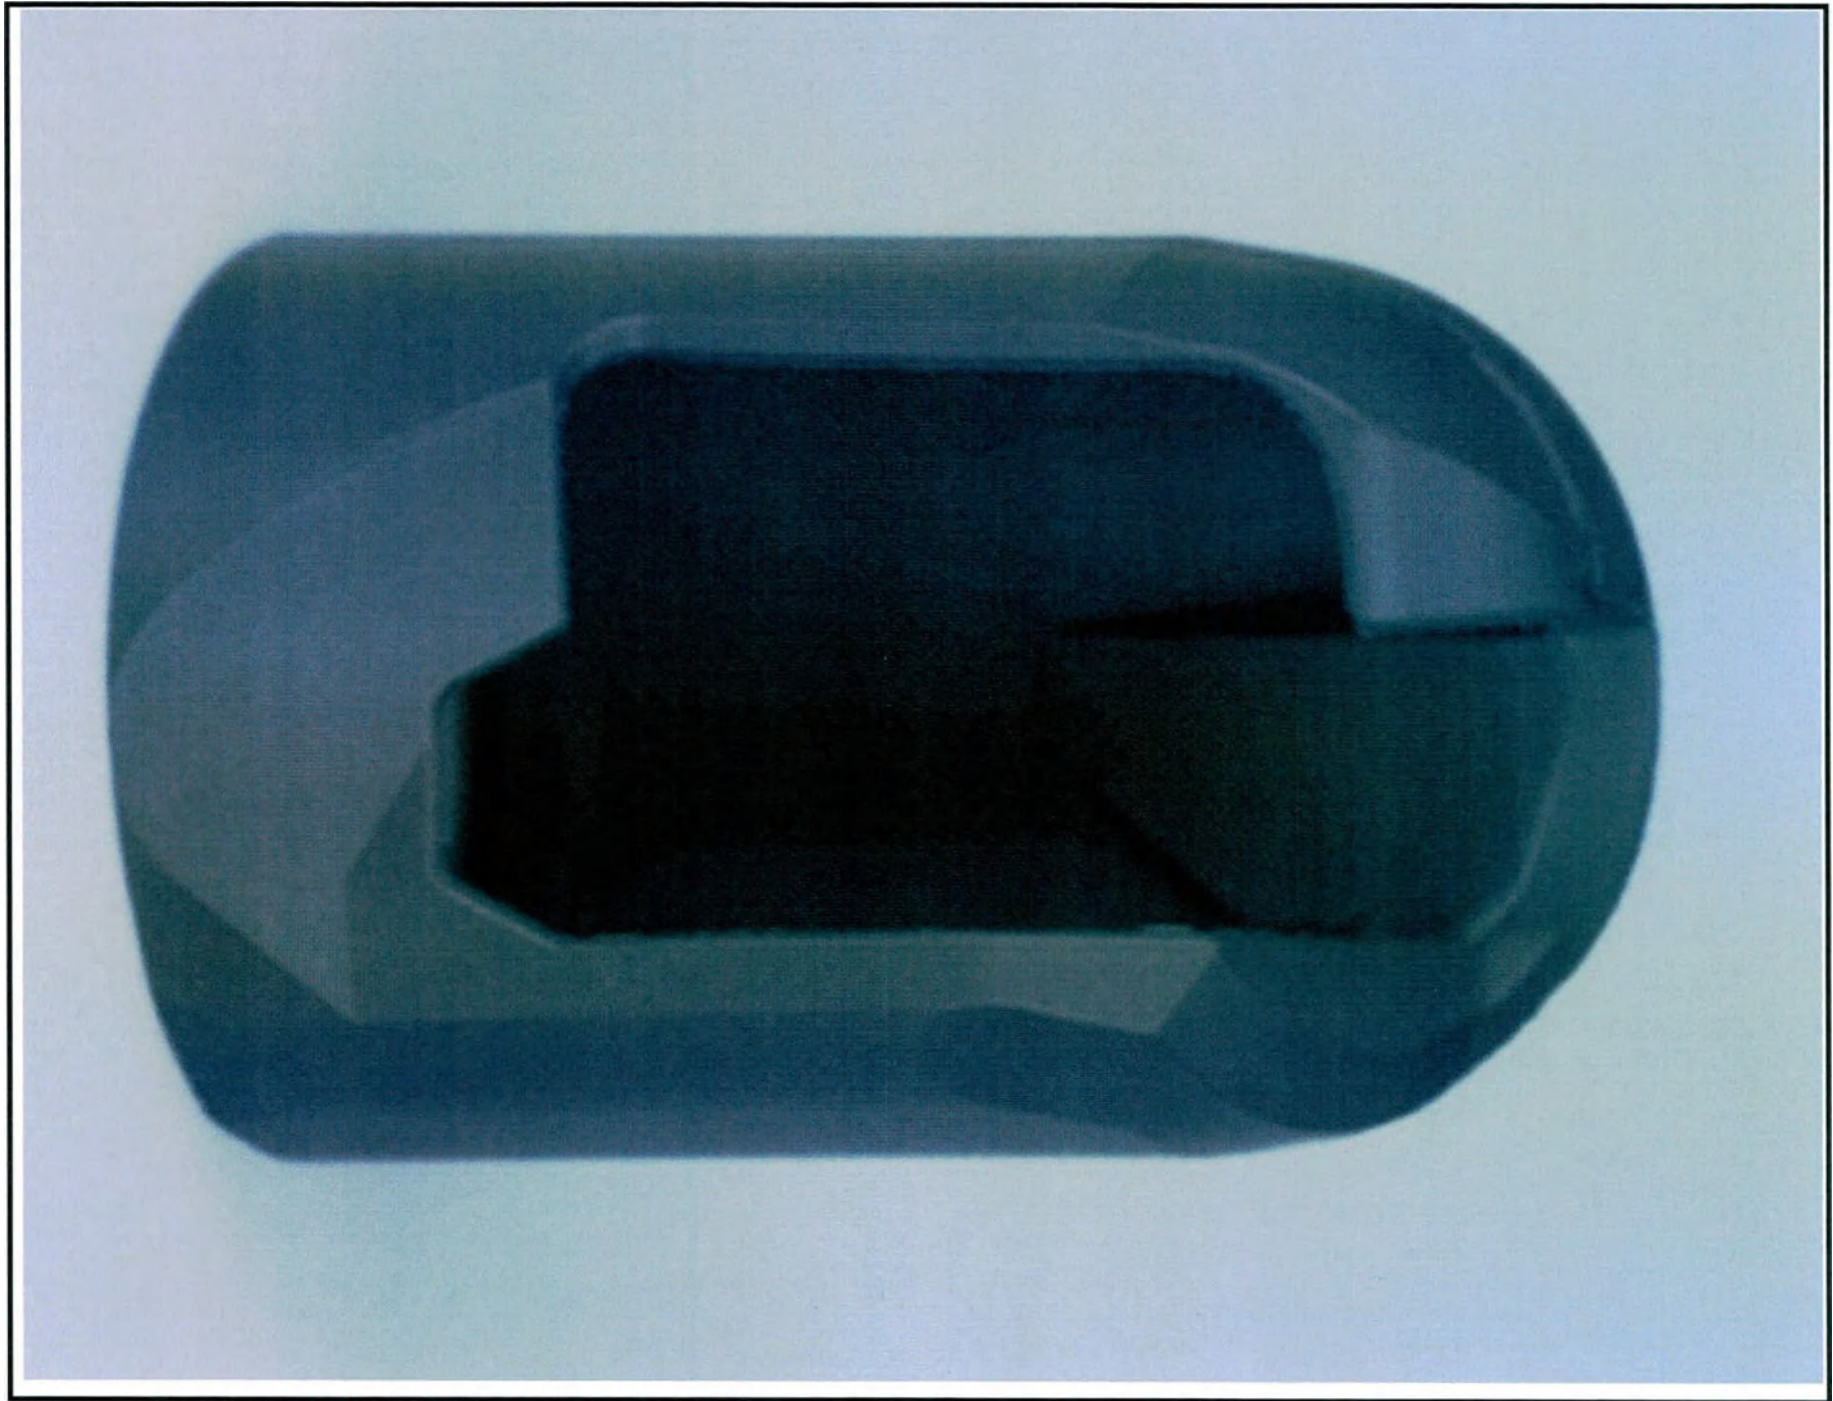

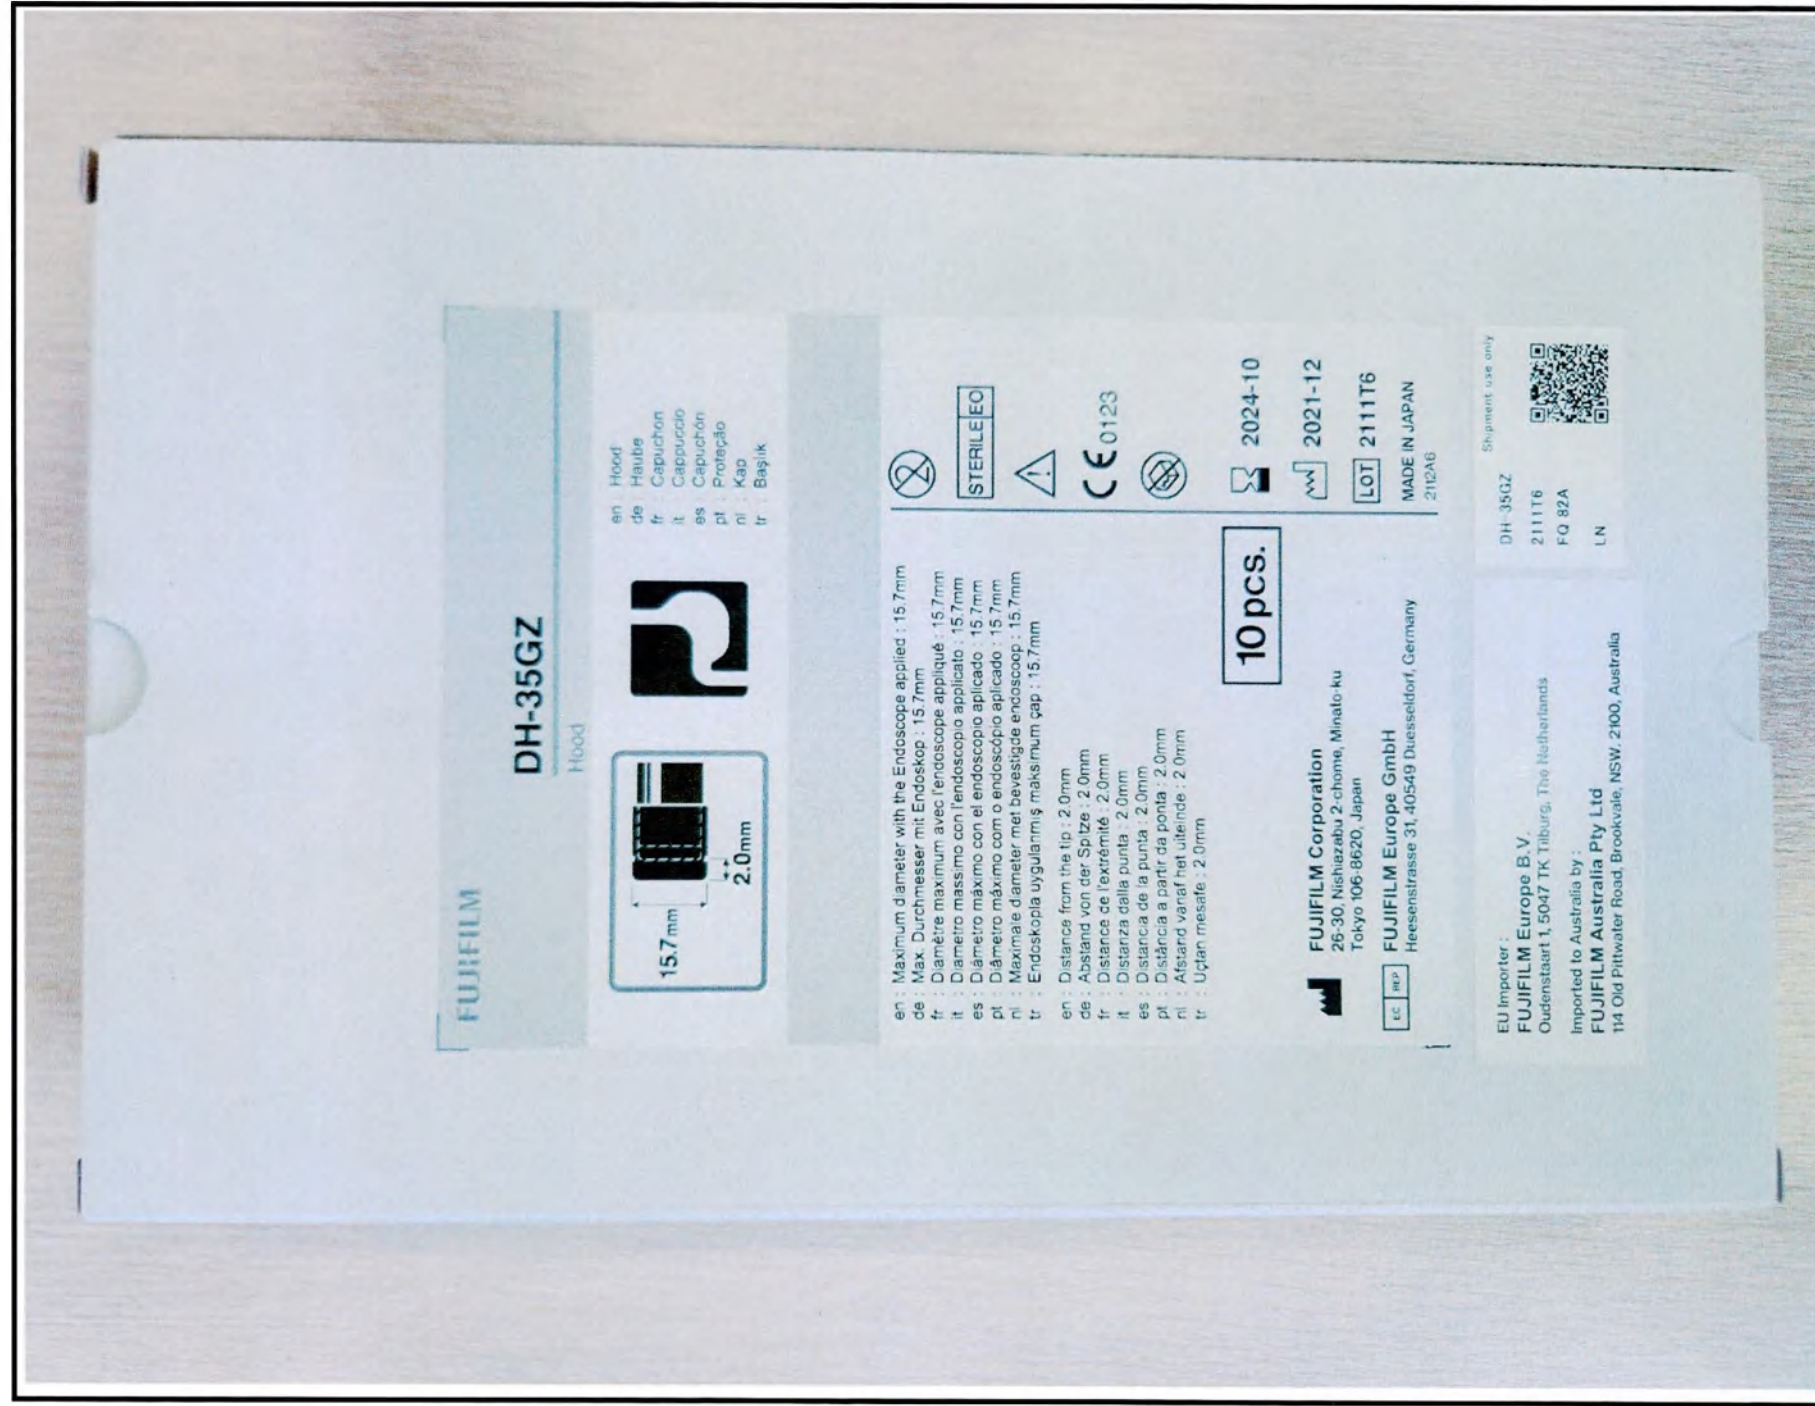



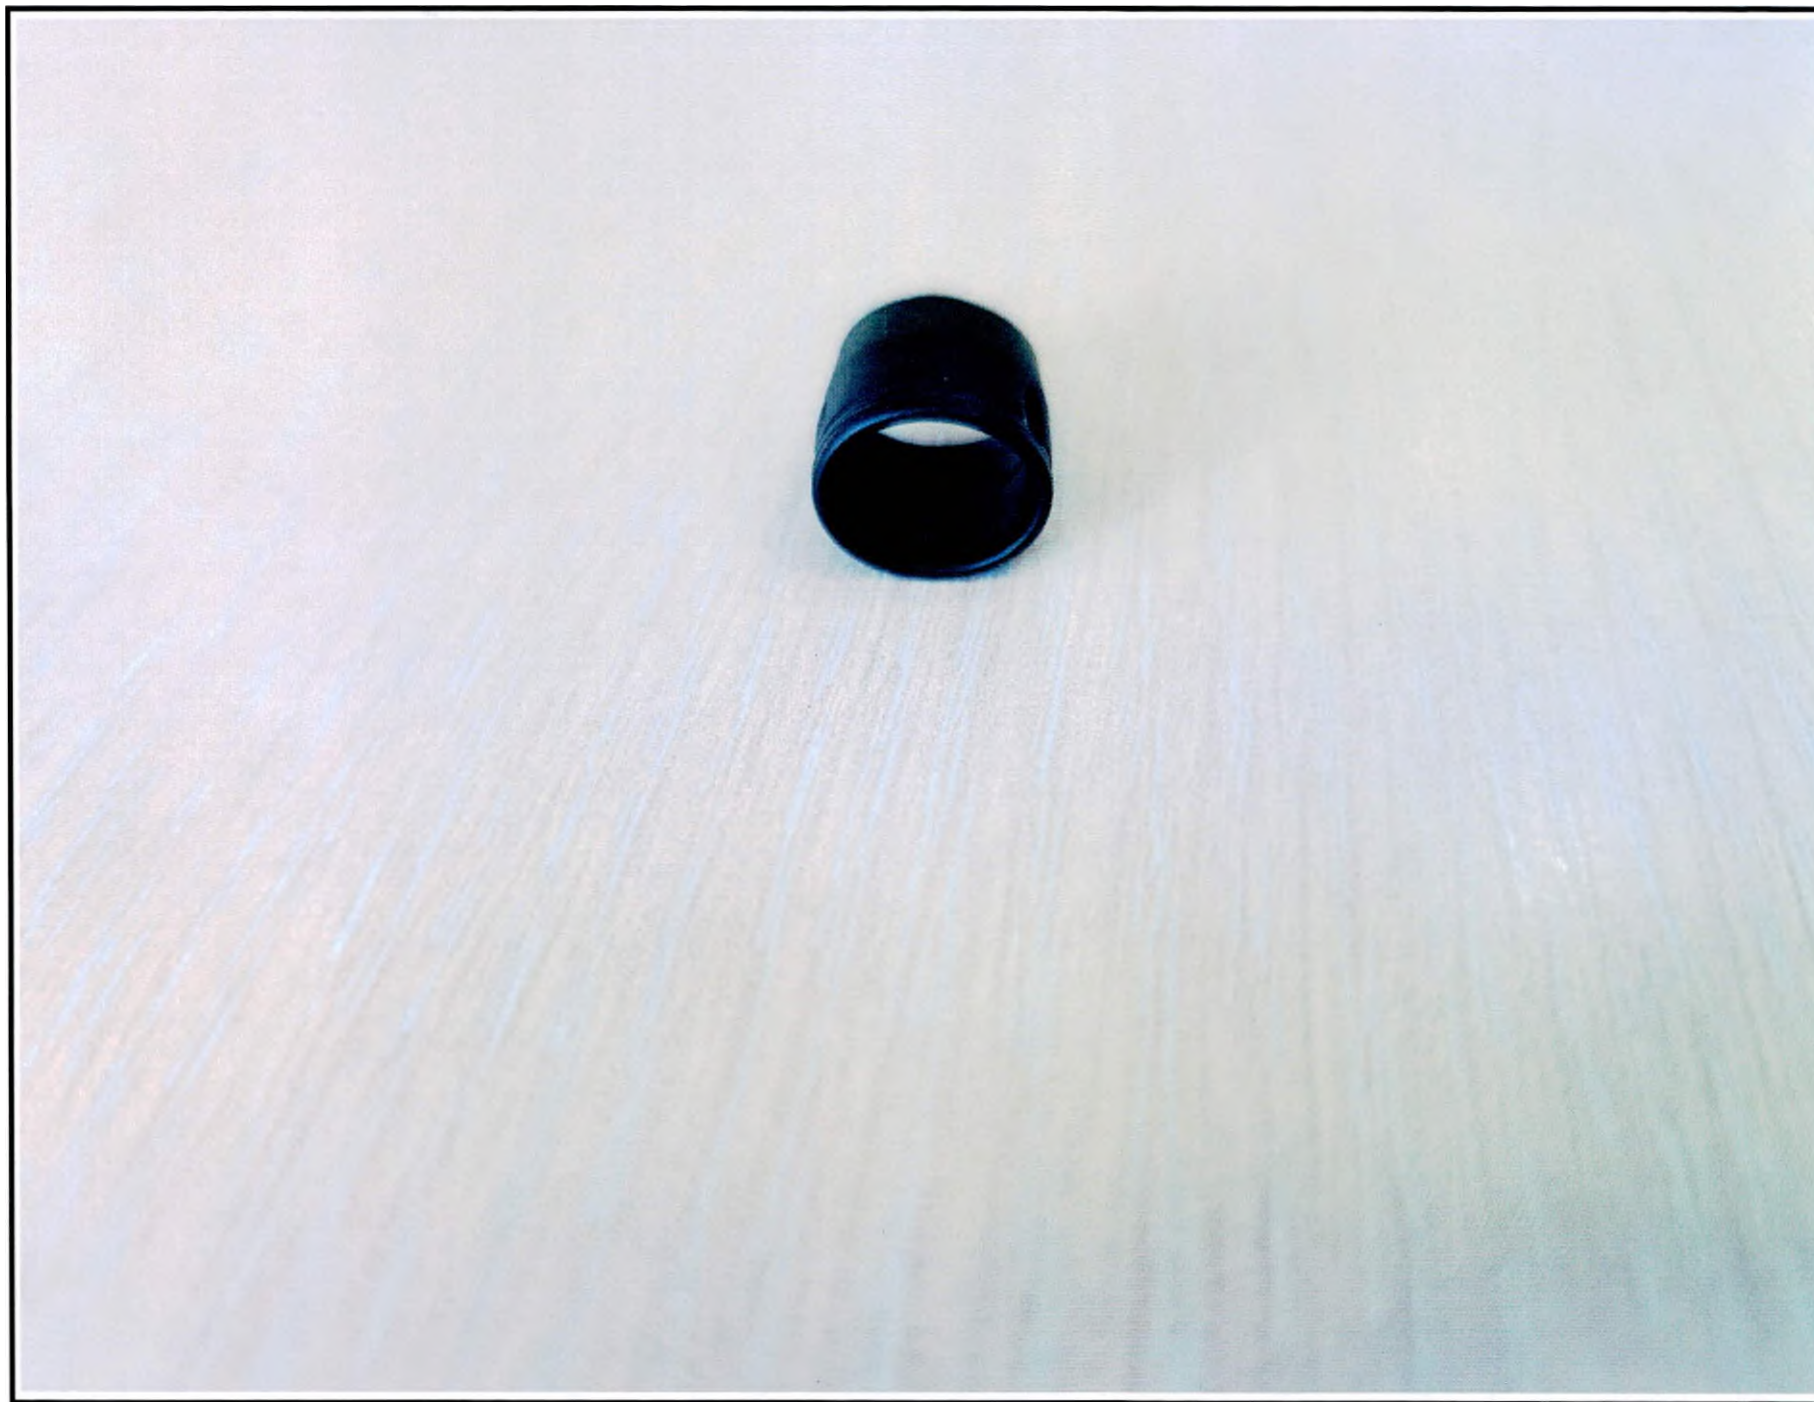

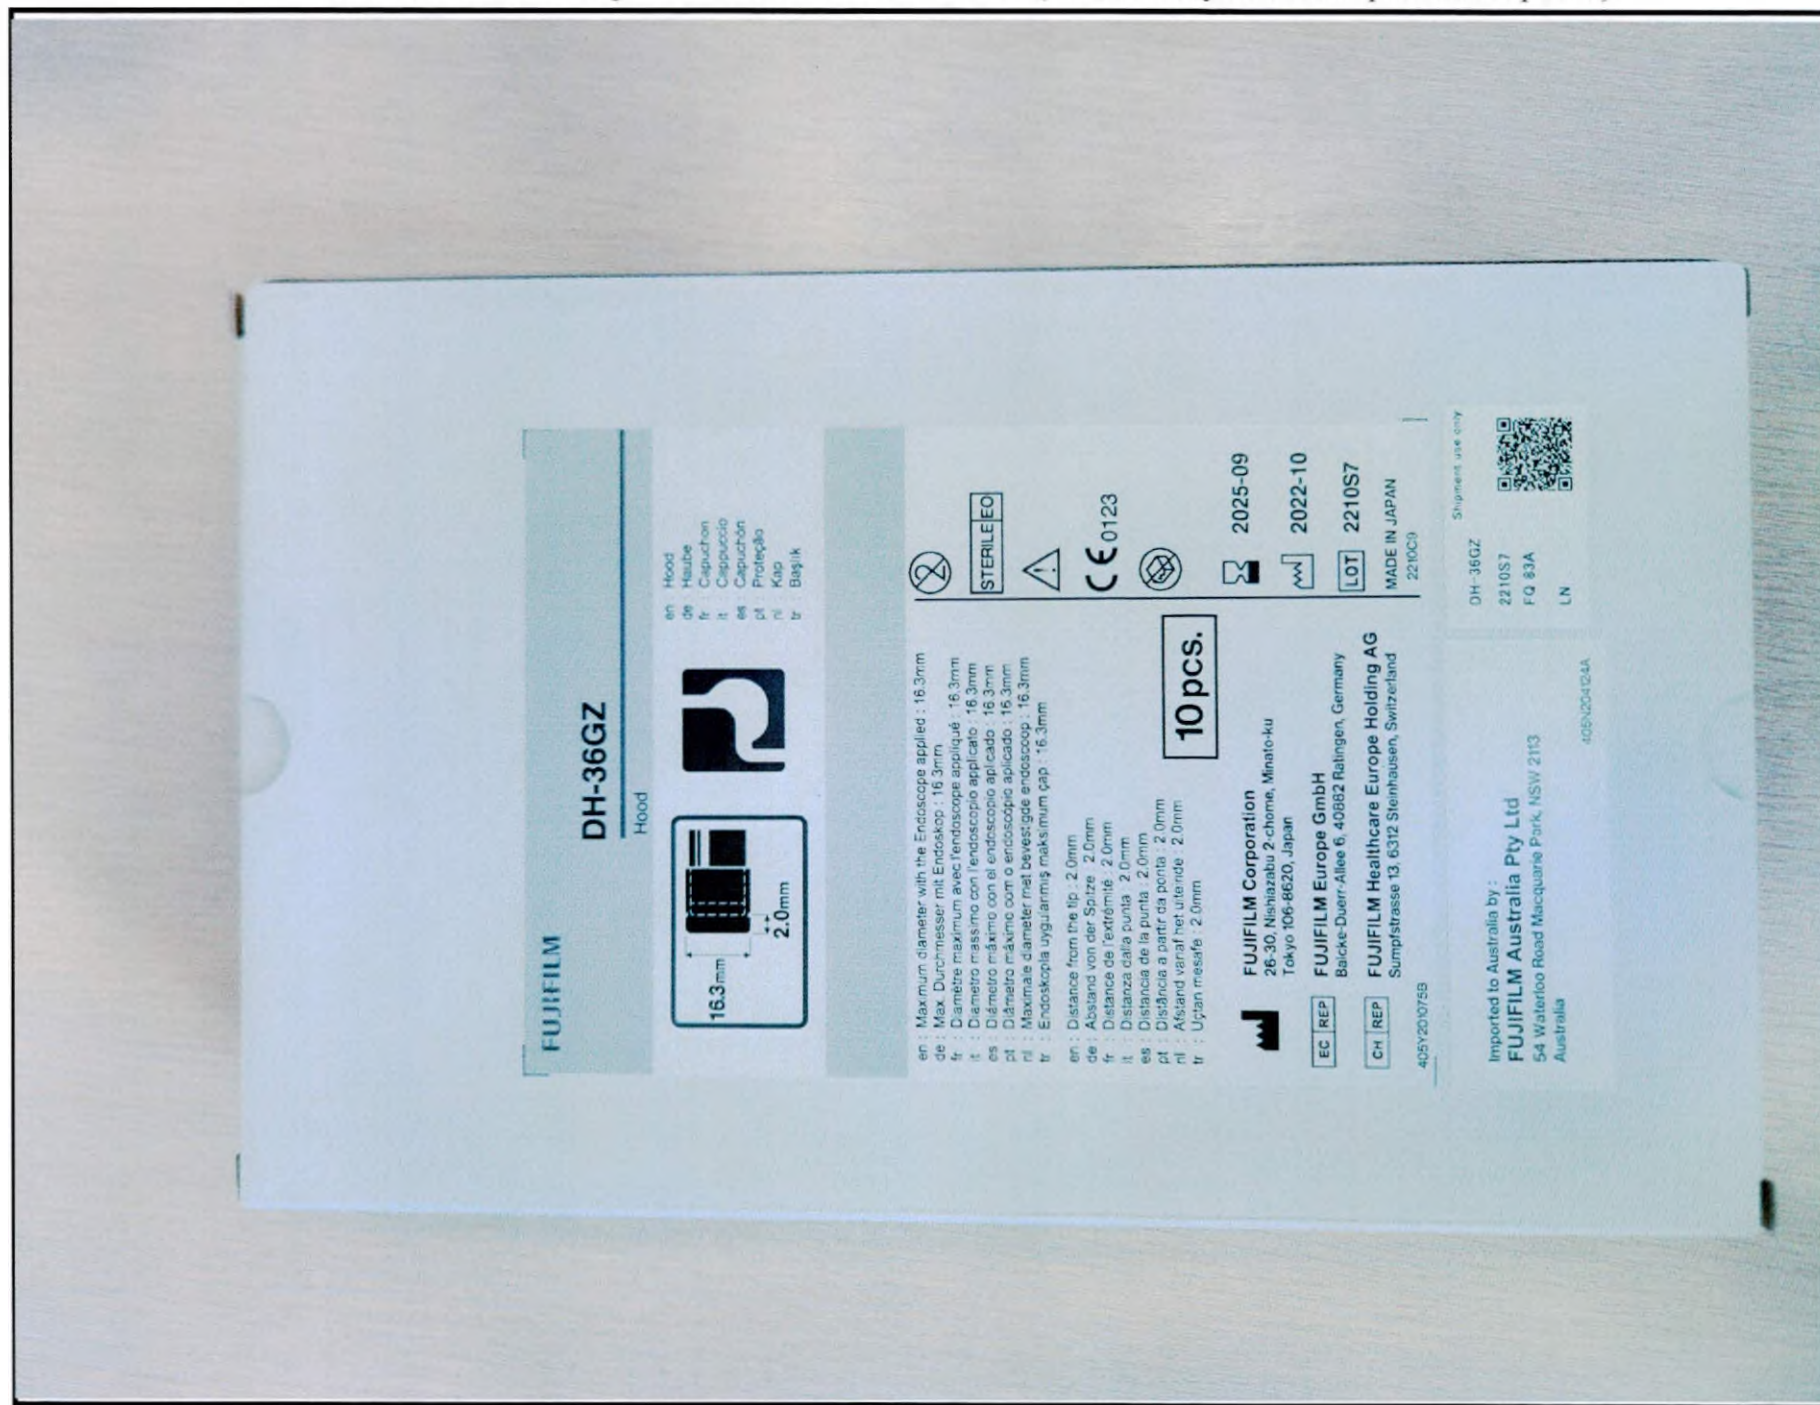






FUJIFILM

DH-37CZ

Hood



en Hood
de Haube
fr Capuchon
it Cappuccio
es Capuchón
pt Proteção
nl Kap
tr Başlık

en : Maximum diameter with the Endoscope applied : 16.1mm
de : Max. Durchmesser mit Endoskop : 16.1mm
fr : Diamètre maximum avec l'endoscope appliqué : 16.1mm
it : Diametro massimo con l'endoscopio applicato : 16.1mm
es : Diámetro máximo con el endoscopio aplicado : 16.1mm
pt : Diâmetro máximo com o endoscópio aplicado : 16.1mm
nl : Maximale diameter met bevestigde endoscoop : 16.1mm
tr : Endoskopi uygulanmış maksimum çap : 16.1mm

en : Distance from the tip : 2.0mm
de : Abstand von der Spitze : 2.0mm
fr : Distance de l'extrémité : 2.0mm
it : Distanza dalla punta : 2.0mm
es : Distancia de la punta : 2.0mm
pt : Distância a partir da ponta : 2.0mm
nl : Afstand vanaf het uiteinde : 2.0mm
tr : Uçtan mesafe : 2.0mm

10 pcs.



FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan

EC REP

FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen, Germany

CH REP

FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
Sumpfstrasse 13, 6312 Steinhausen, Switzerland

405Y201077B

Imported to Australia by:
FUJIFILM Australia Pty Ltd
54 Waterloo Road Macquarie Park, NSW 2113
Australia

405N204124A



STERILE EO



CE 0123



2025-09



2022-10

LOT

2210S5

MADE IN JAPAN
2210C7

Shipment use only

DH-37CZ

2210S5

FQ 84A

LN








FUJIFILM

DH-38CZ

Hood



en : Hood
de : Haube
fr : Capuchon
it : Cappuccio
es : Capuchón
pt : Proteção
nl : Kap
tr : Başlık

en : Maximum diameter with the Endoscope applied : 17.4mm
de : Max. Durchmesser mit Endoskop : 17.4mm
fr : Diamètre maximum avec l'endoscope appliqué : 17.4mm
it : Diametro massimo con l'endoscopio applicato : 17.4mm
es : Diámetro máximo con el endoscopio aplicado : 17.4mm
pt : Diâmetro máximo com o endoscópio aplicado : 17.4mm
nl : Maximale diameter met bevestigde endoscoop : 17.4mm
tr : Endoskopi uygulanmış maksimum çap : 17.4mm

en : Distance from the tip : 2.0mm
de : Abstand von der Spitze : 2.0mm
fr : Distance de l'extrémité : 2.0mm
it : Distanza dalla punta : 2.0mm
es : Distancia de la punta : 2.0mm
pt : Distância a partir da ponta : 2.0mm
nl : Afstand vanaf het uiteinde : 2.0mm
tr : Uçtan mesafe : 2.0mm



STERILE EO



CE 0123



2025-01

2022-02

LOT 2202S4

MADE IN JAPAN
2202C7

10 pcs.



FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan



FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany

EU Importer :
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands
Imported to Australia by :
FUJIFILM Australia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW, 2100, Australia

DH-38CZ

2202S4

FQ 85A


LN

Shipment use only







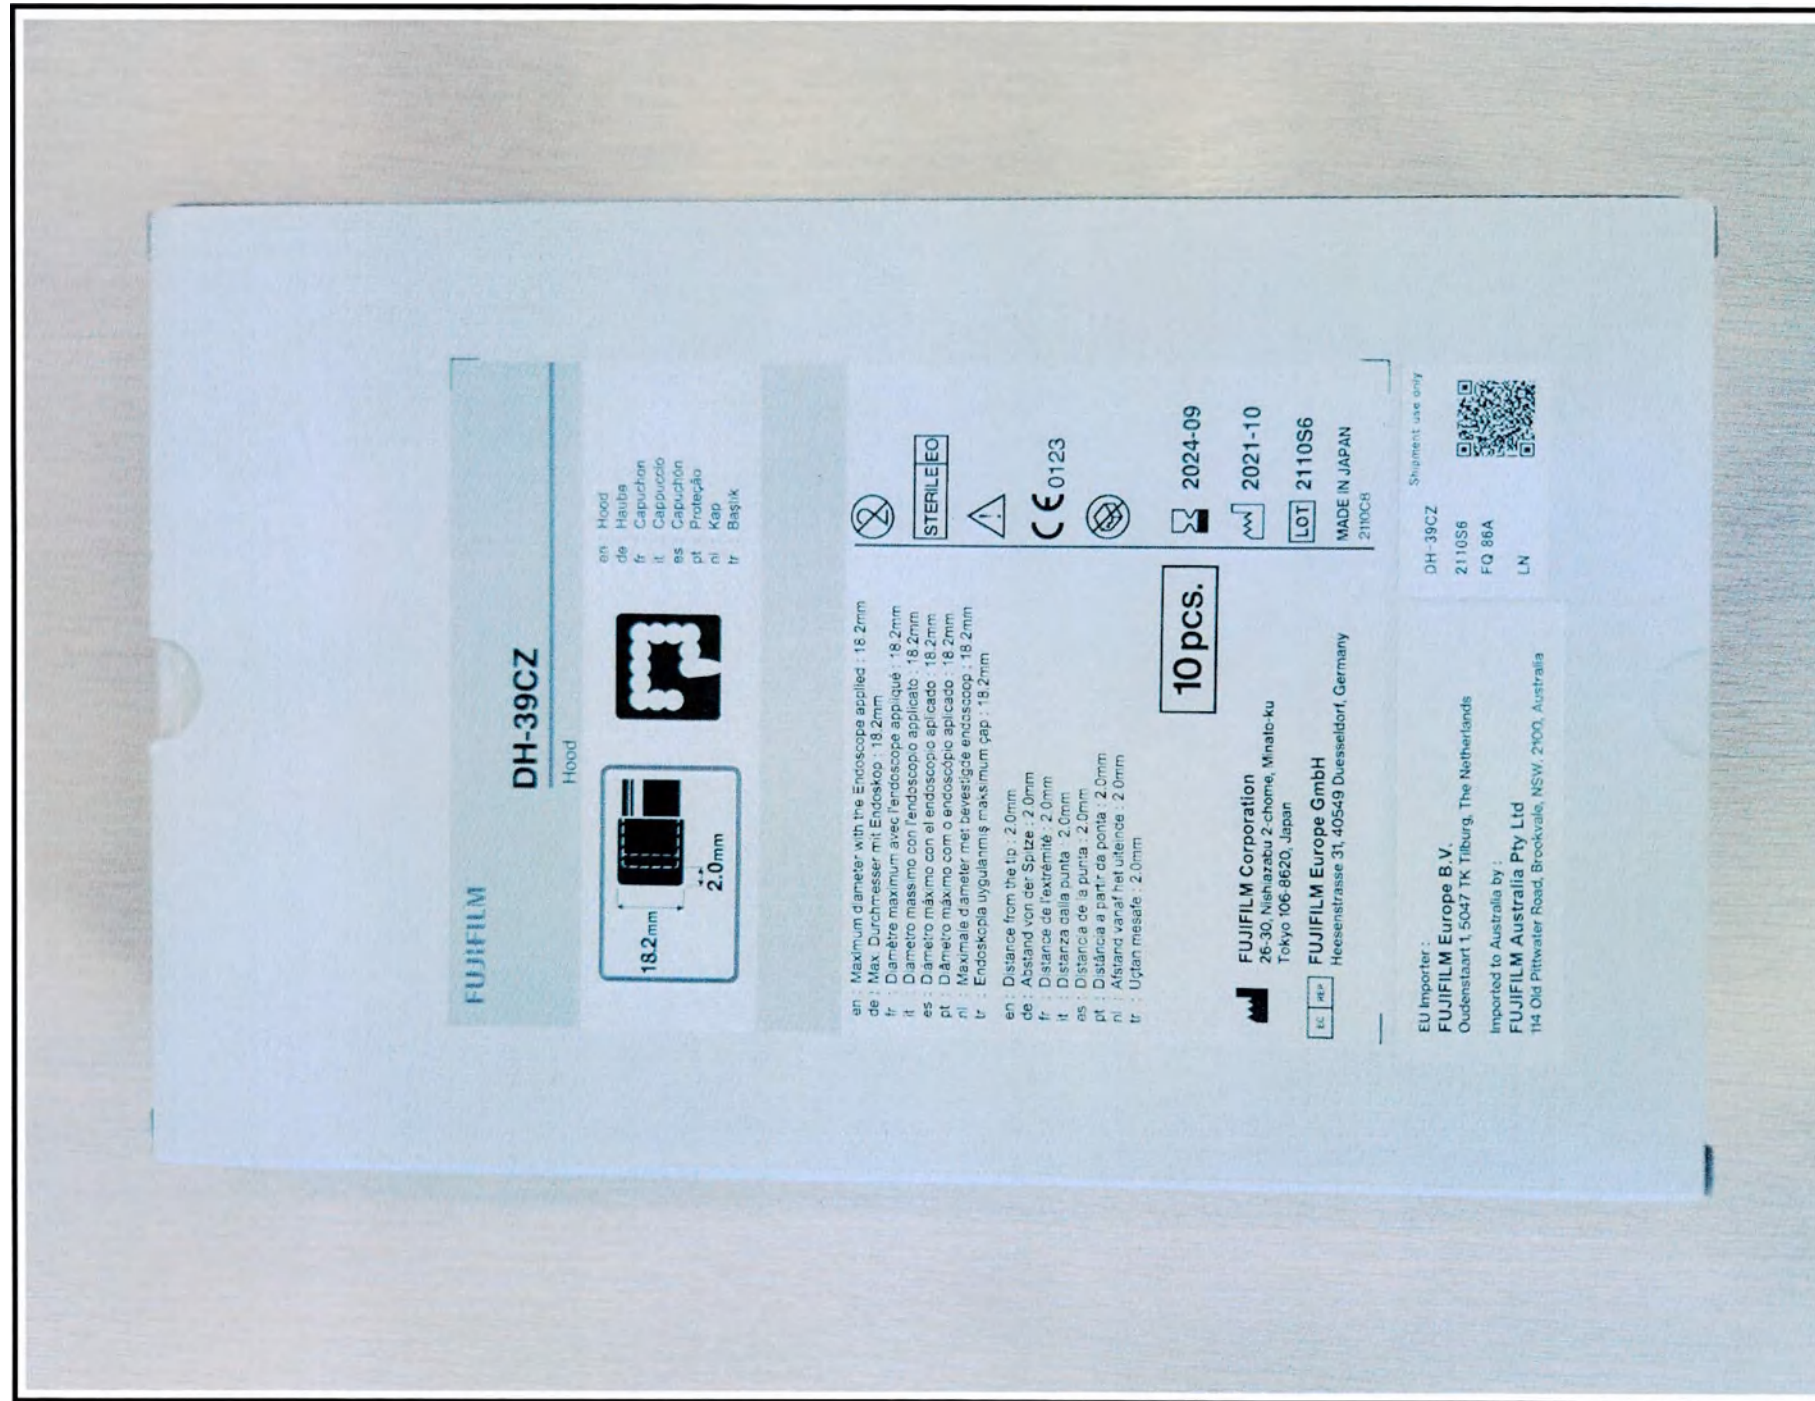












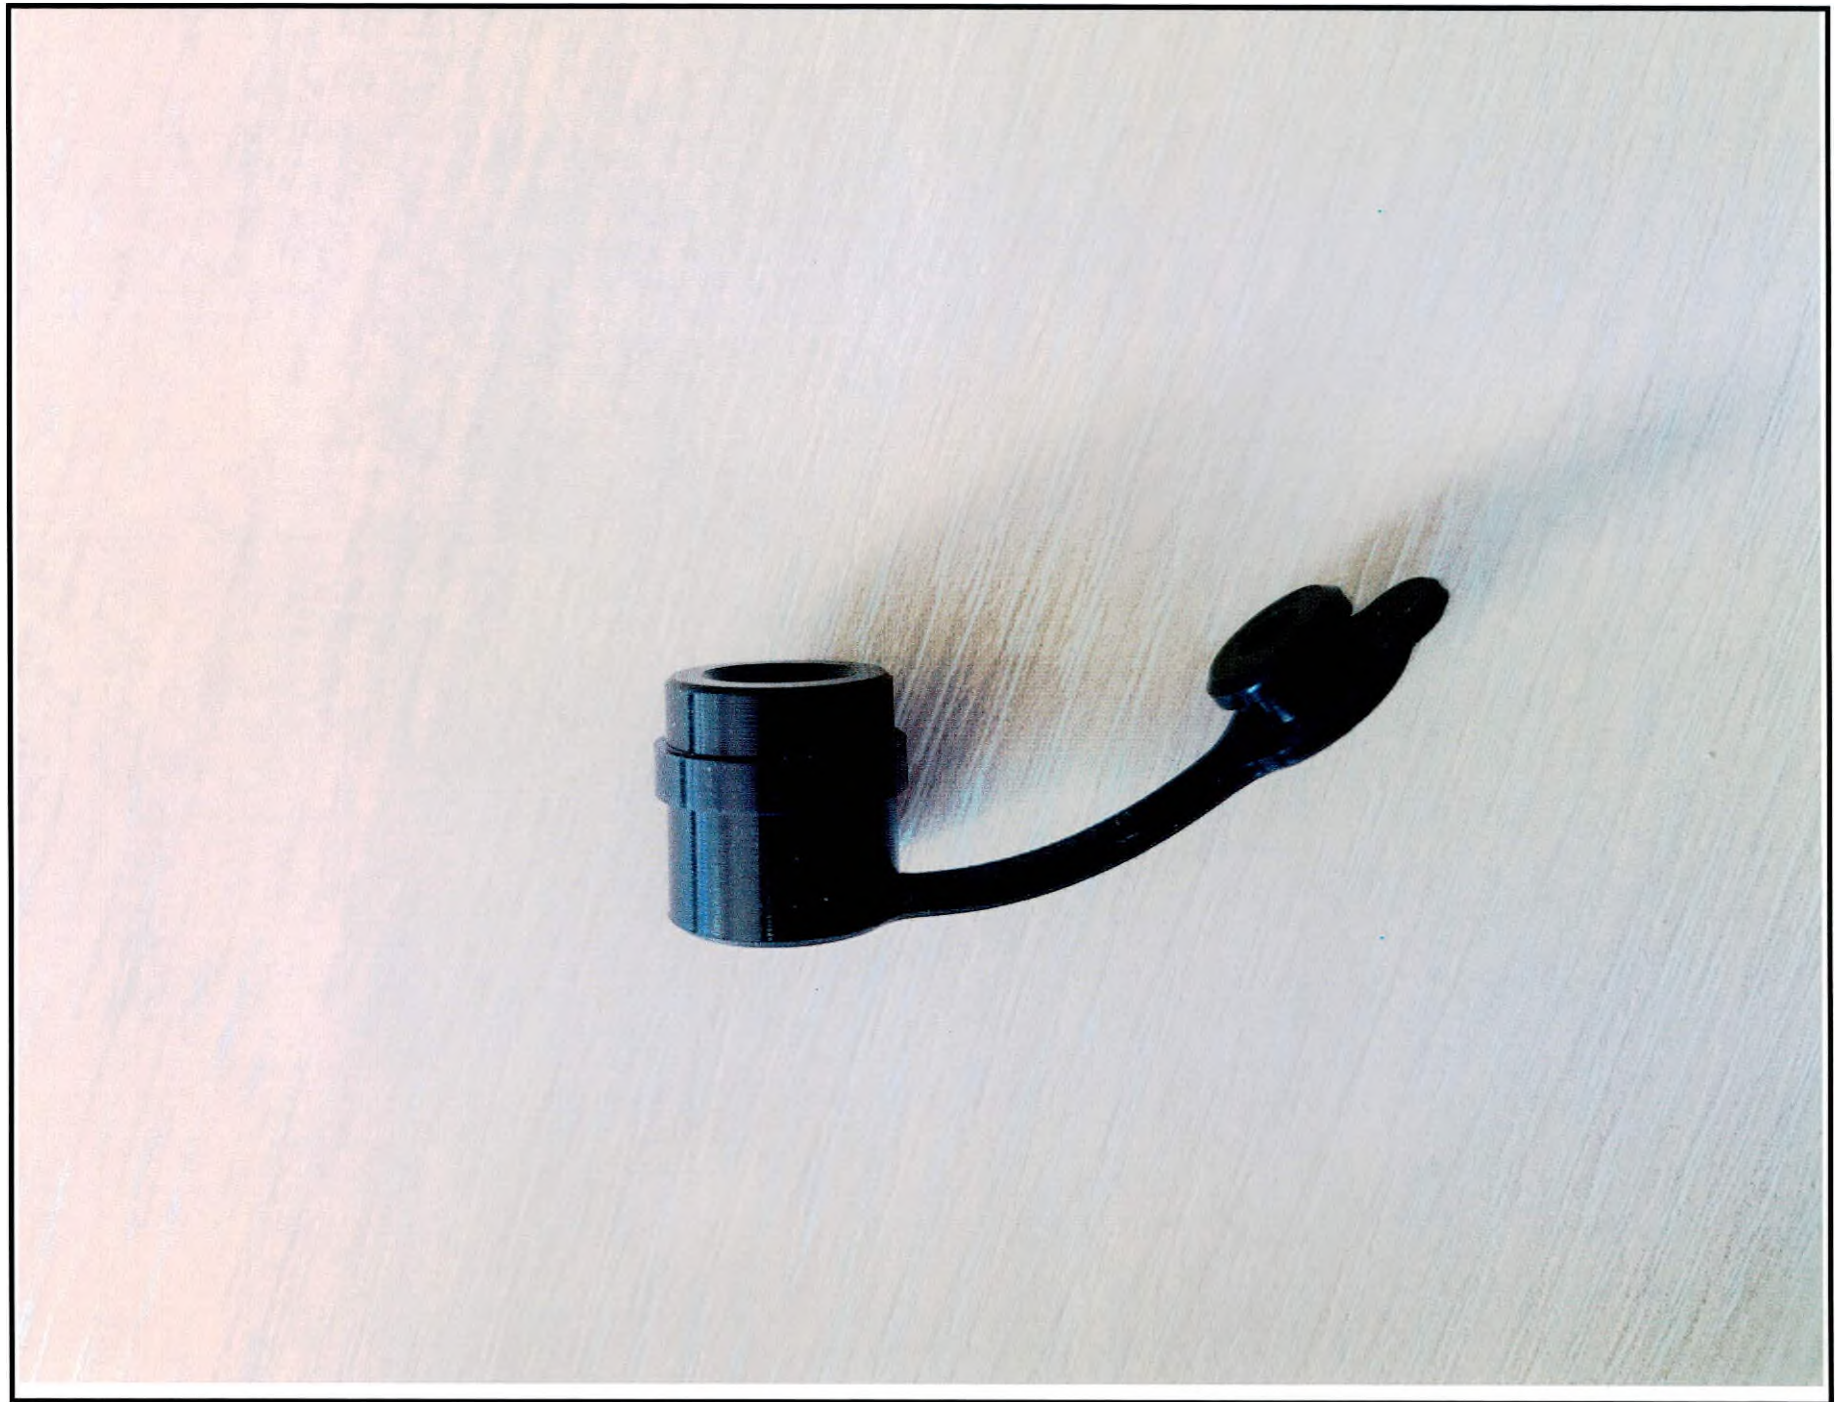





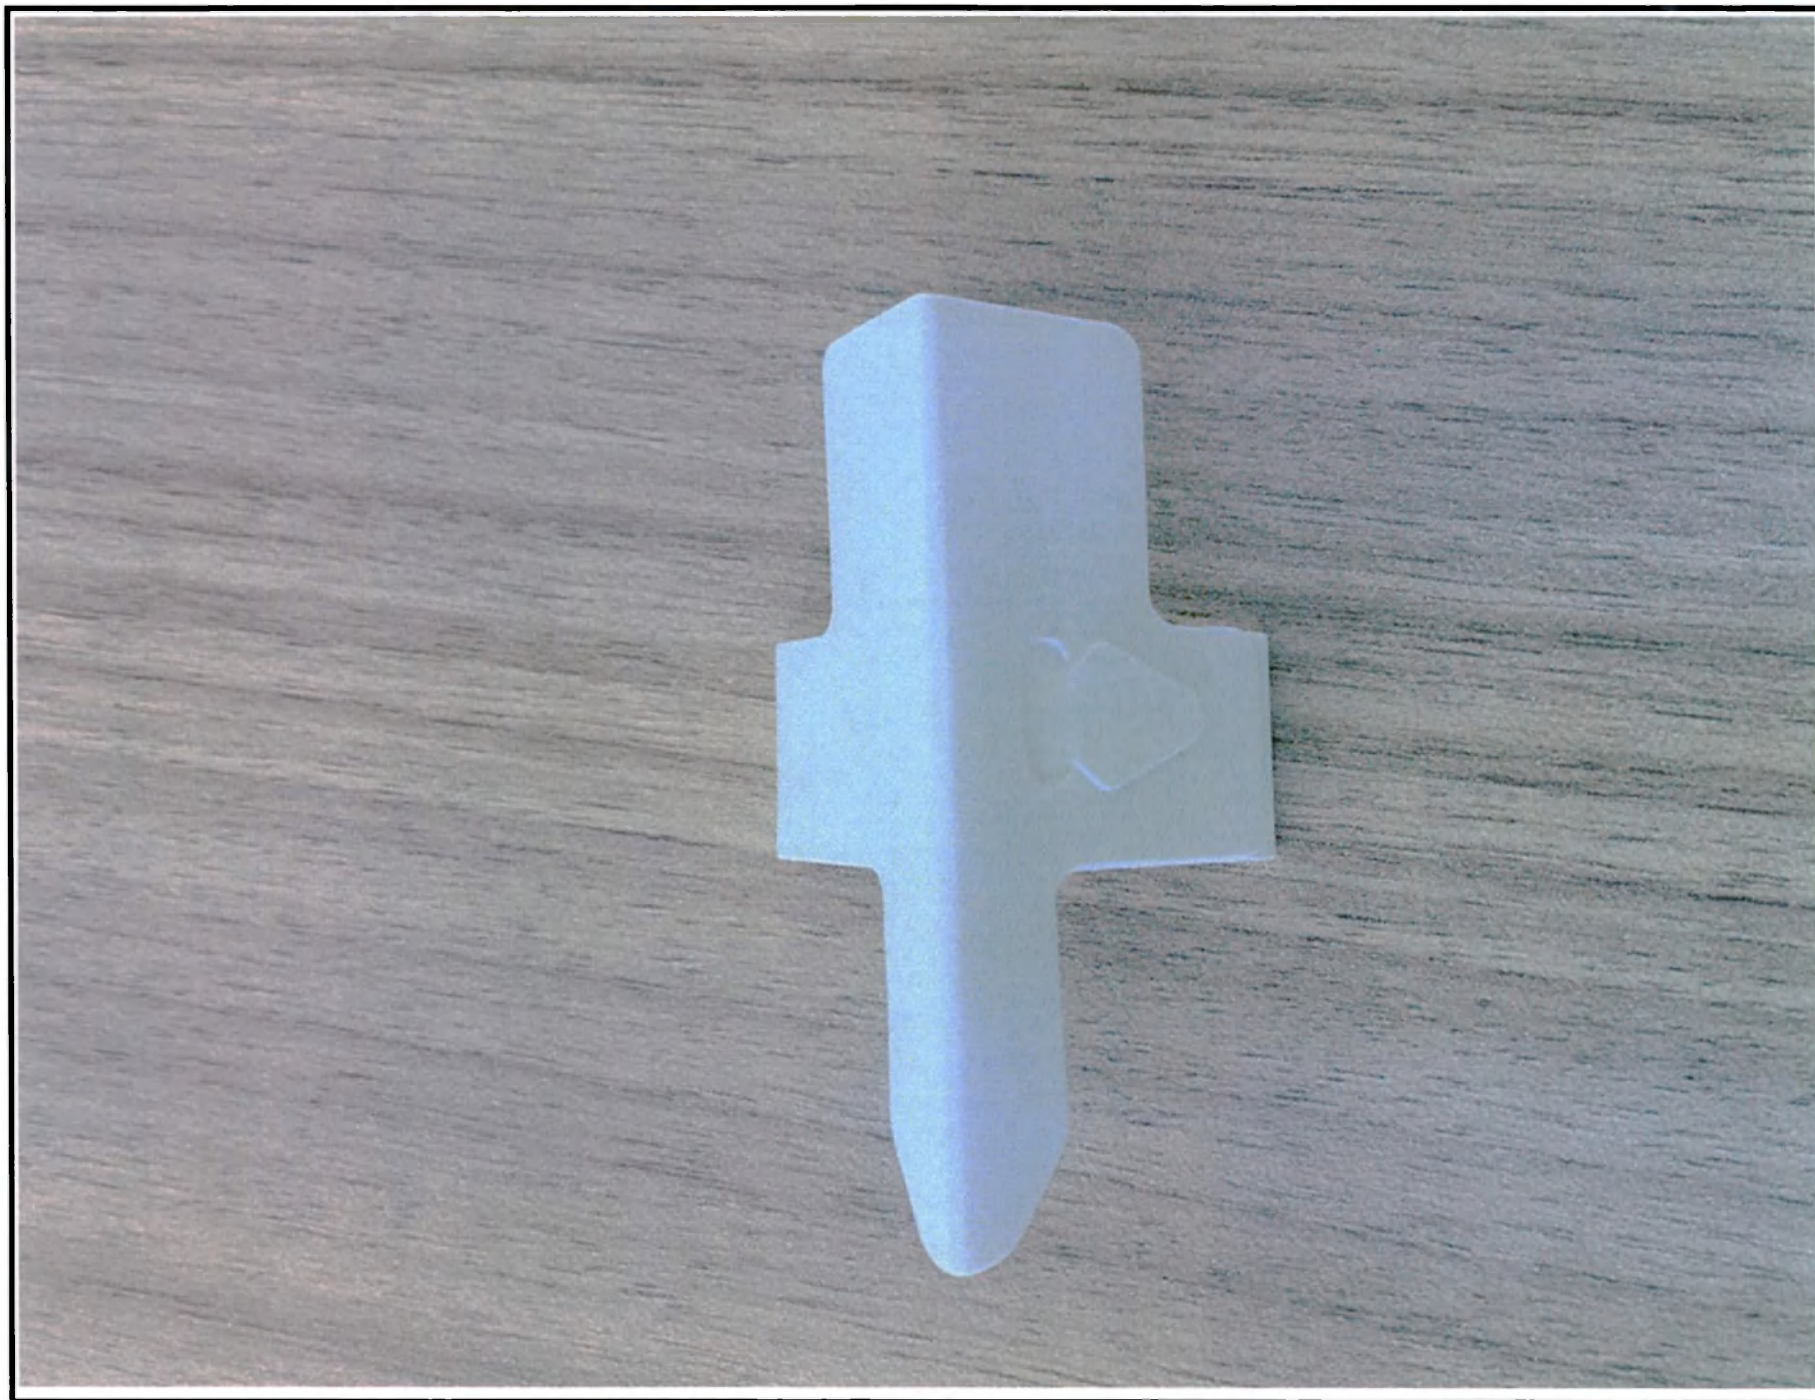


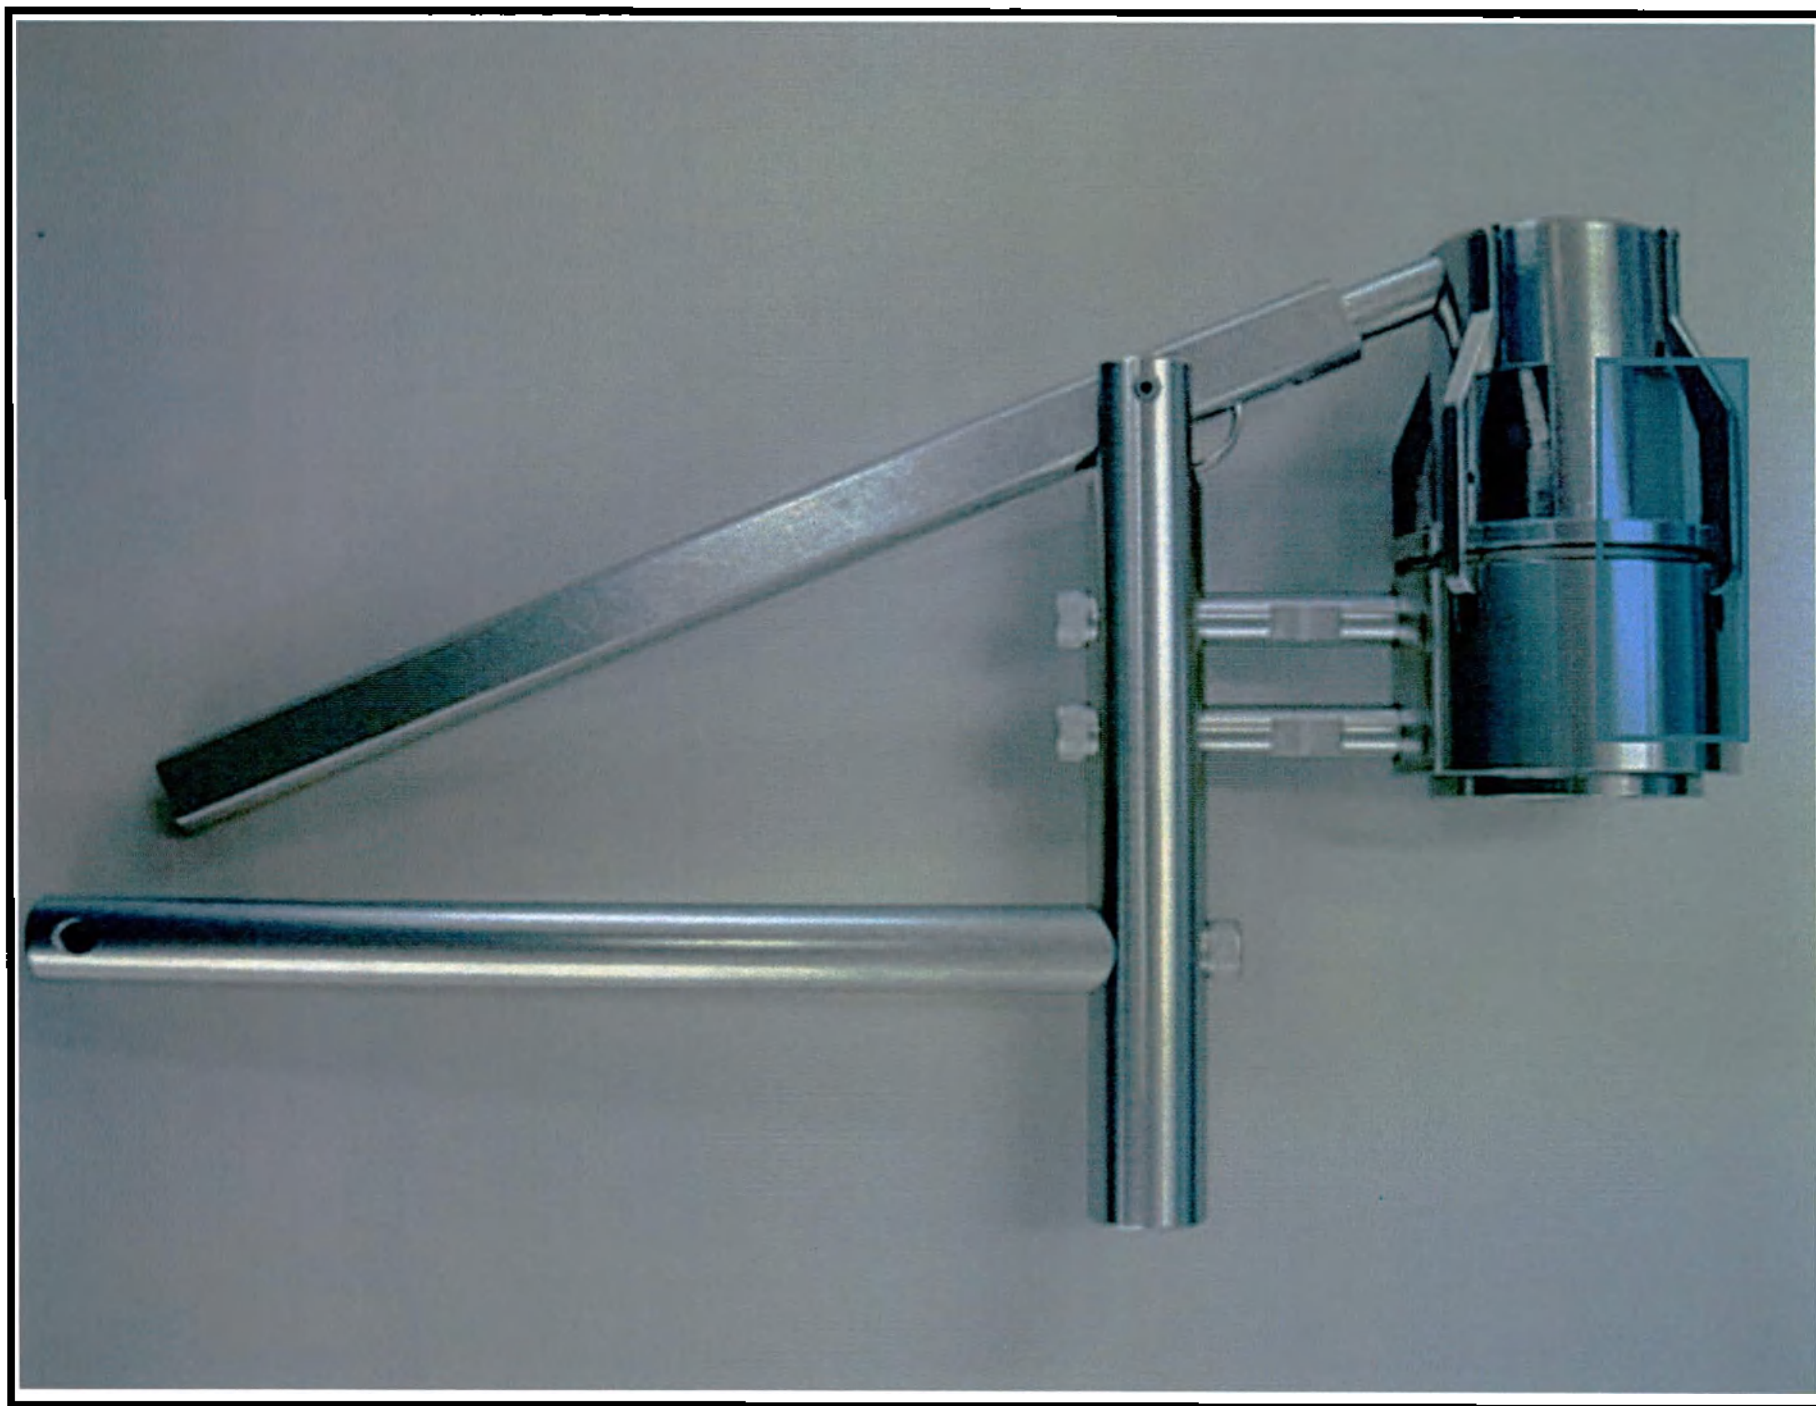









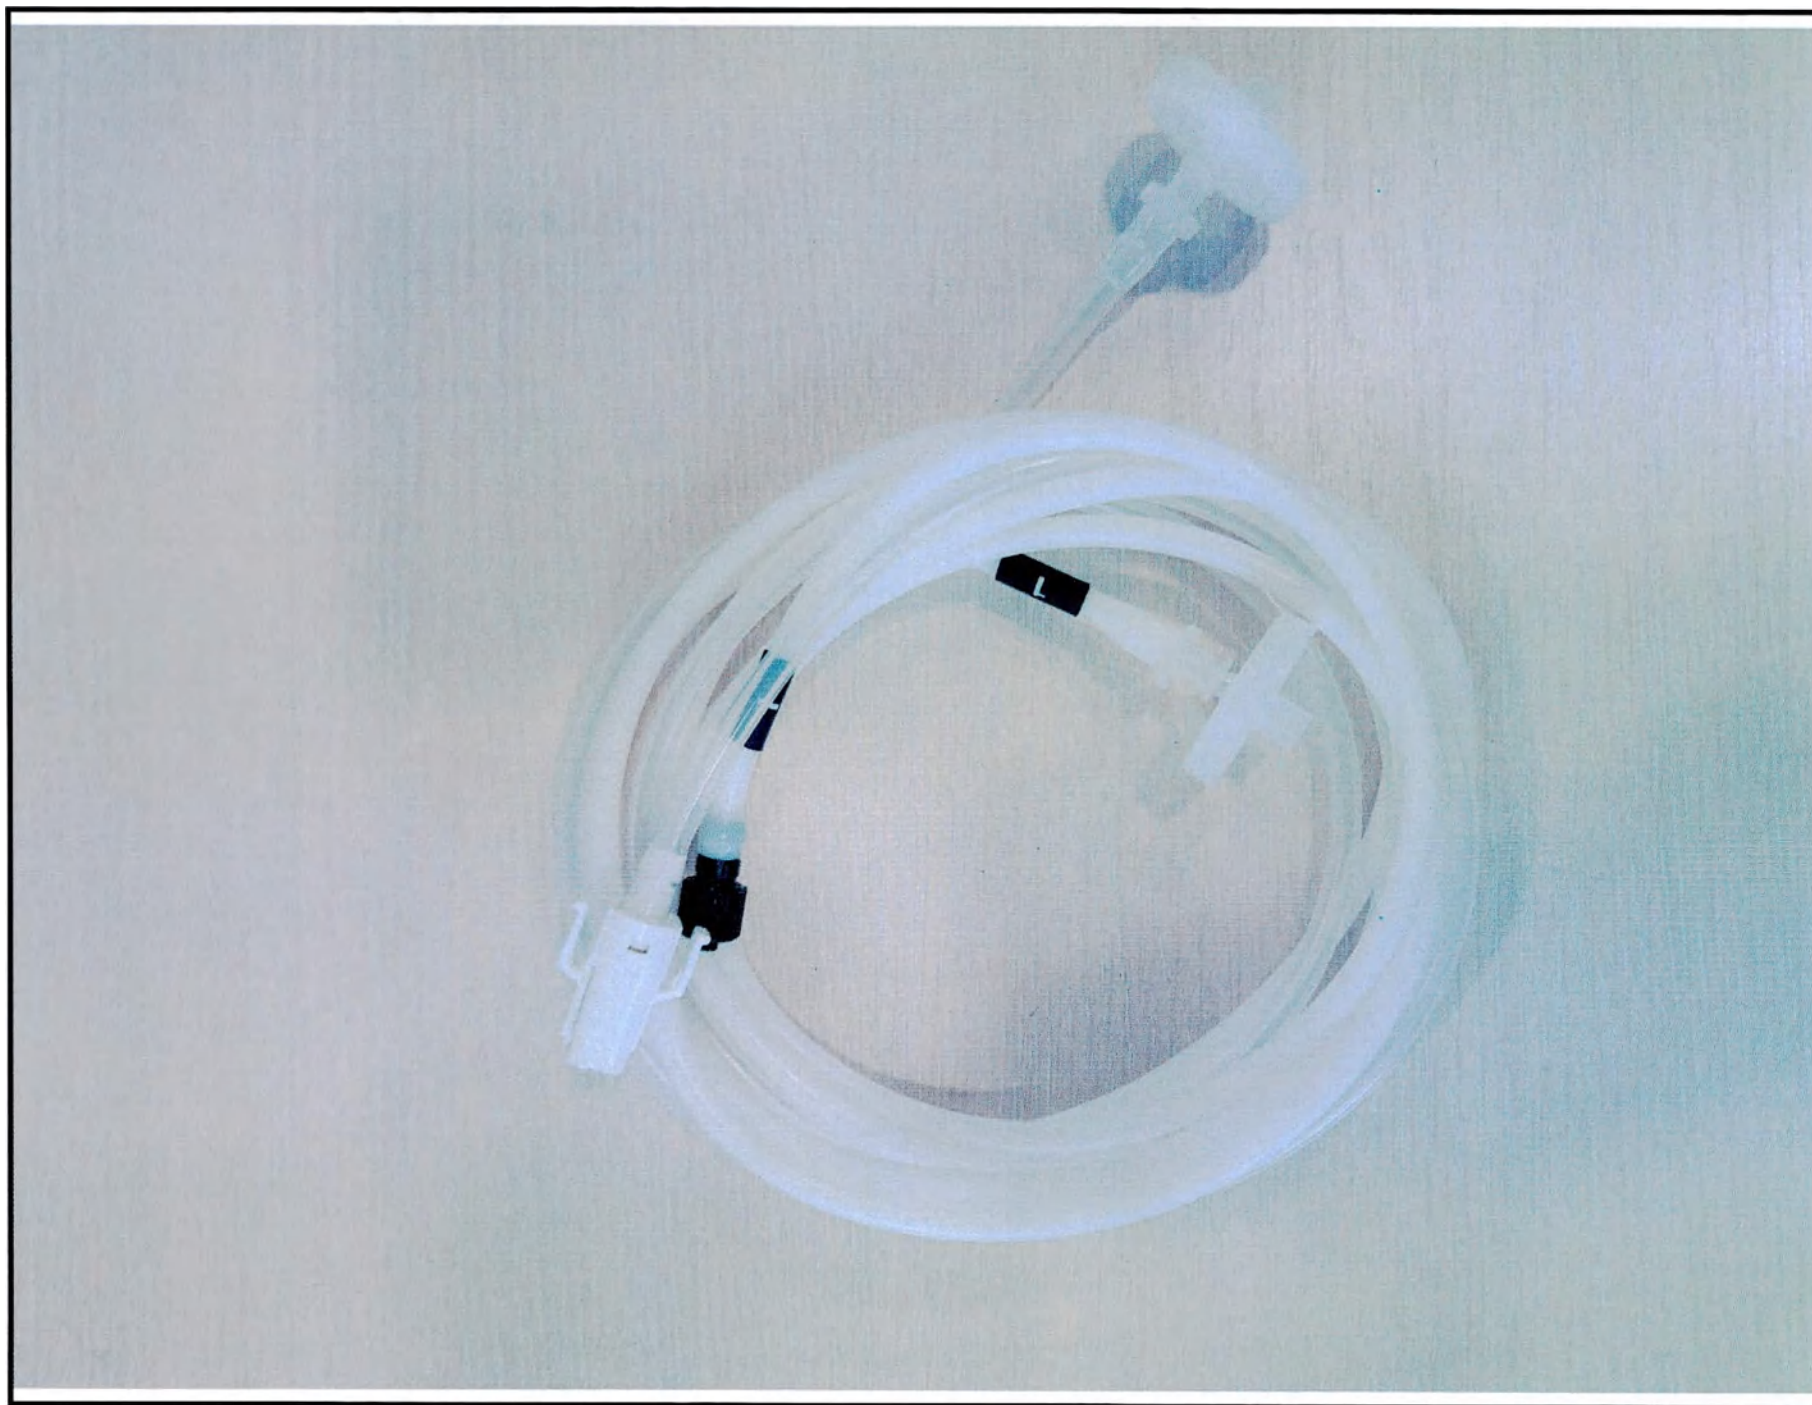


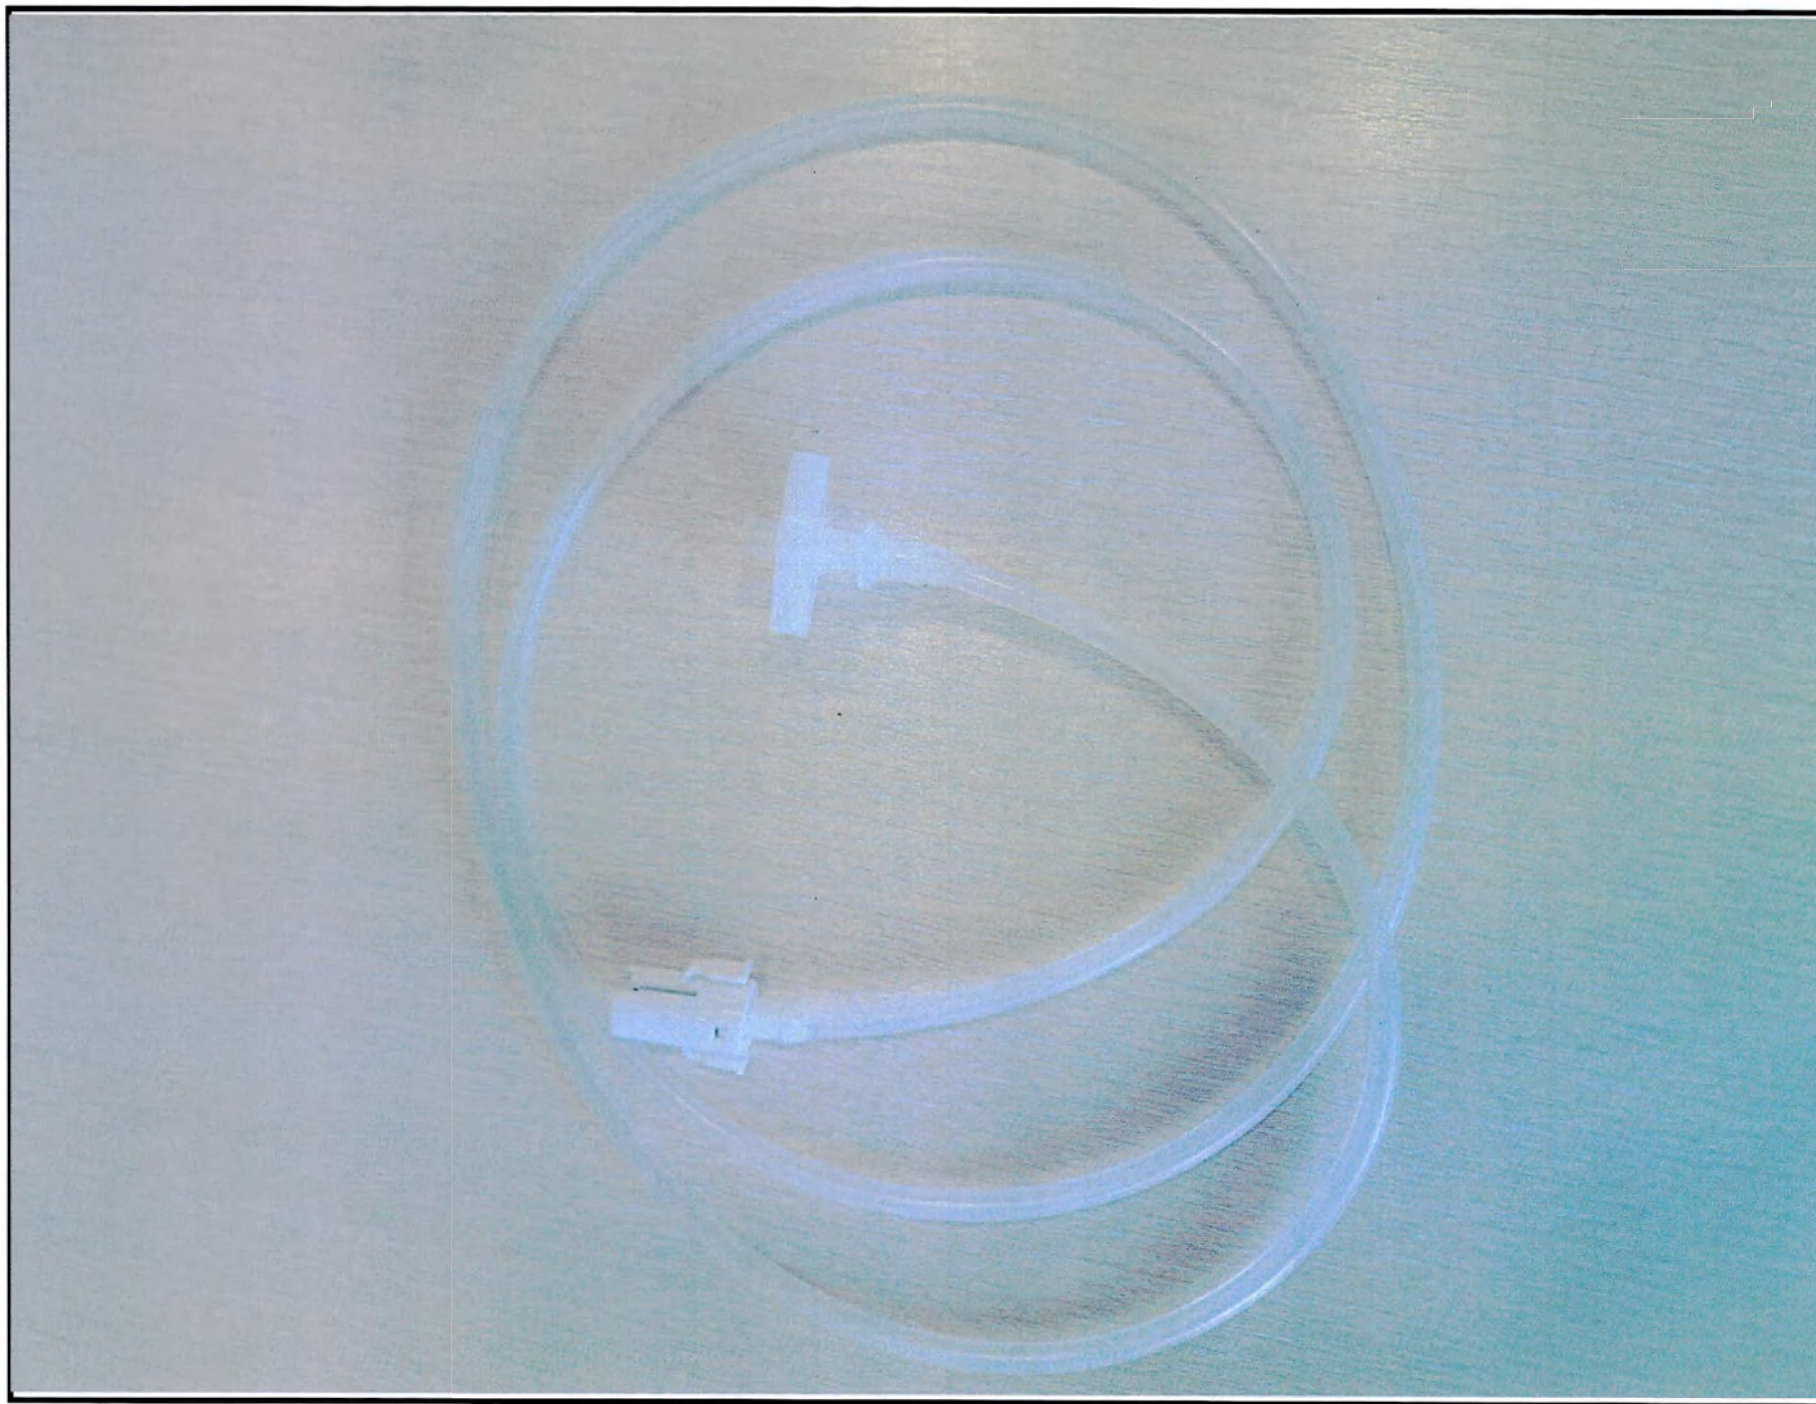







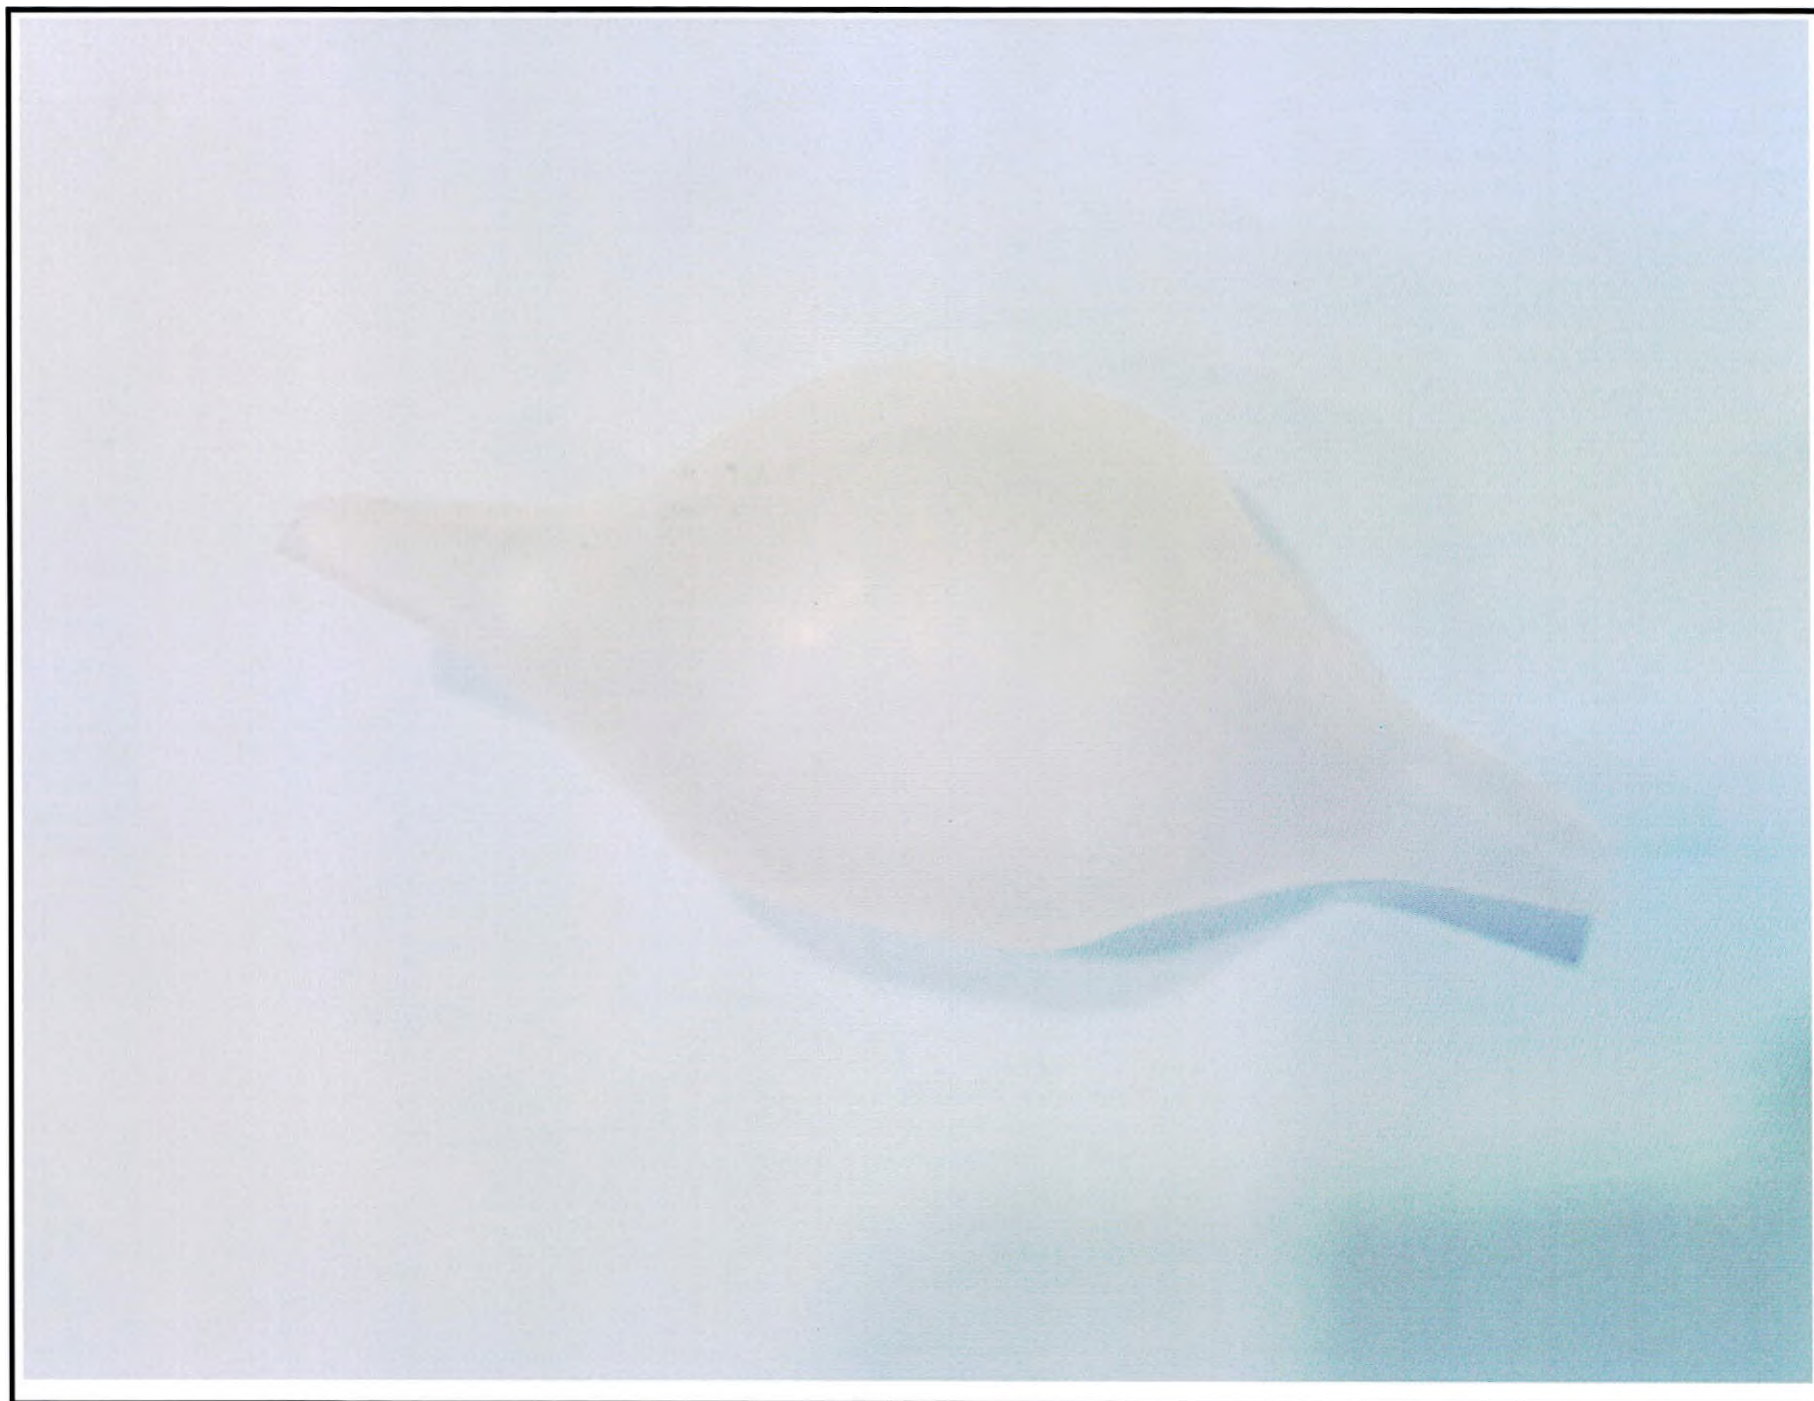

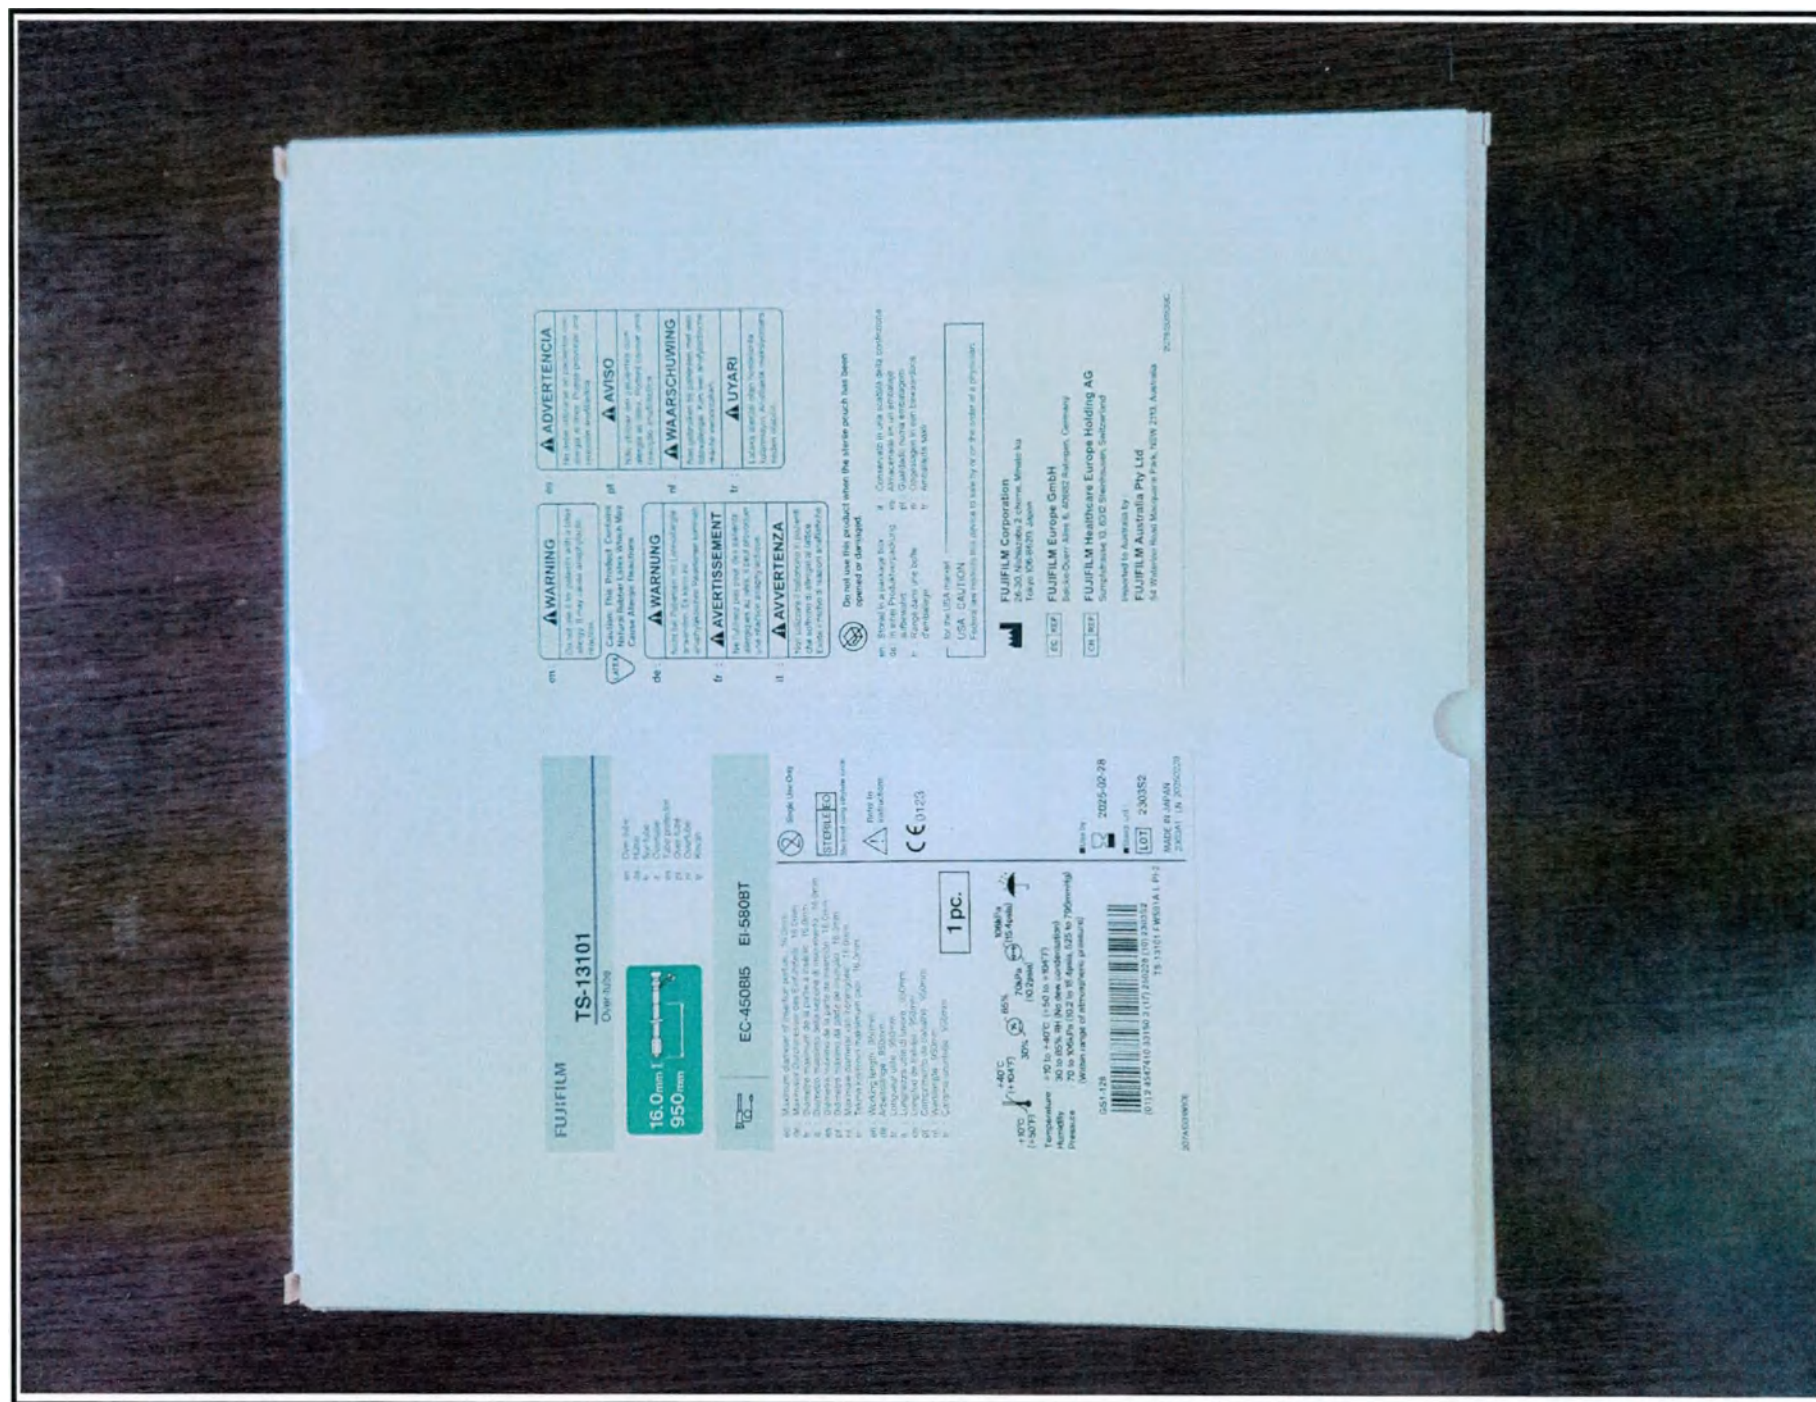

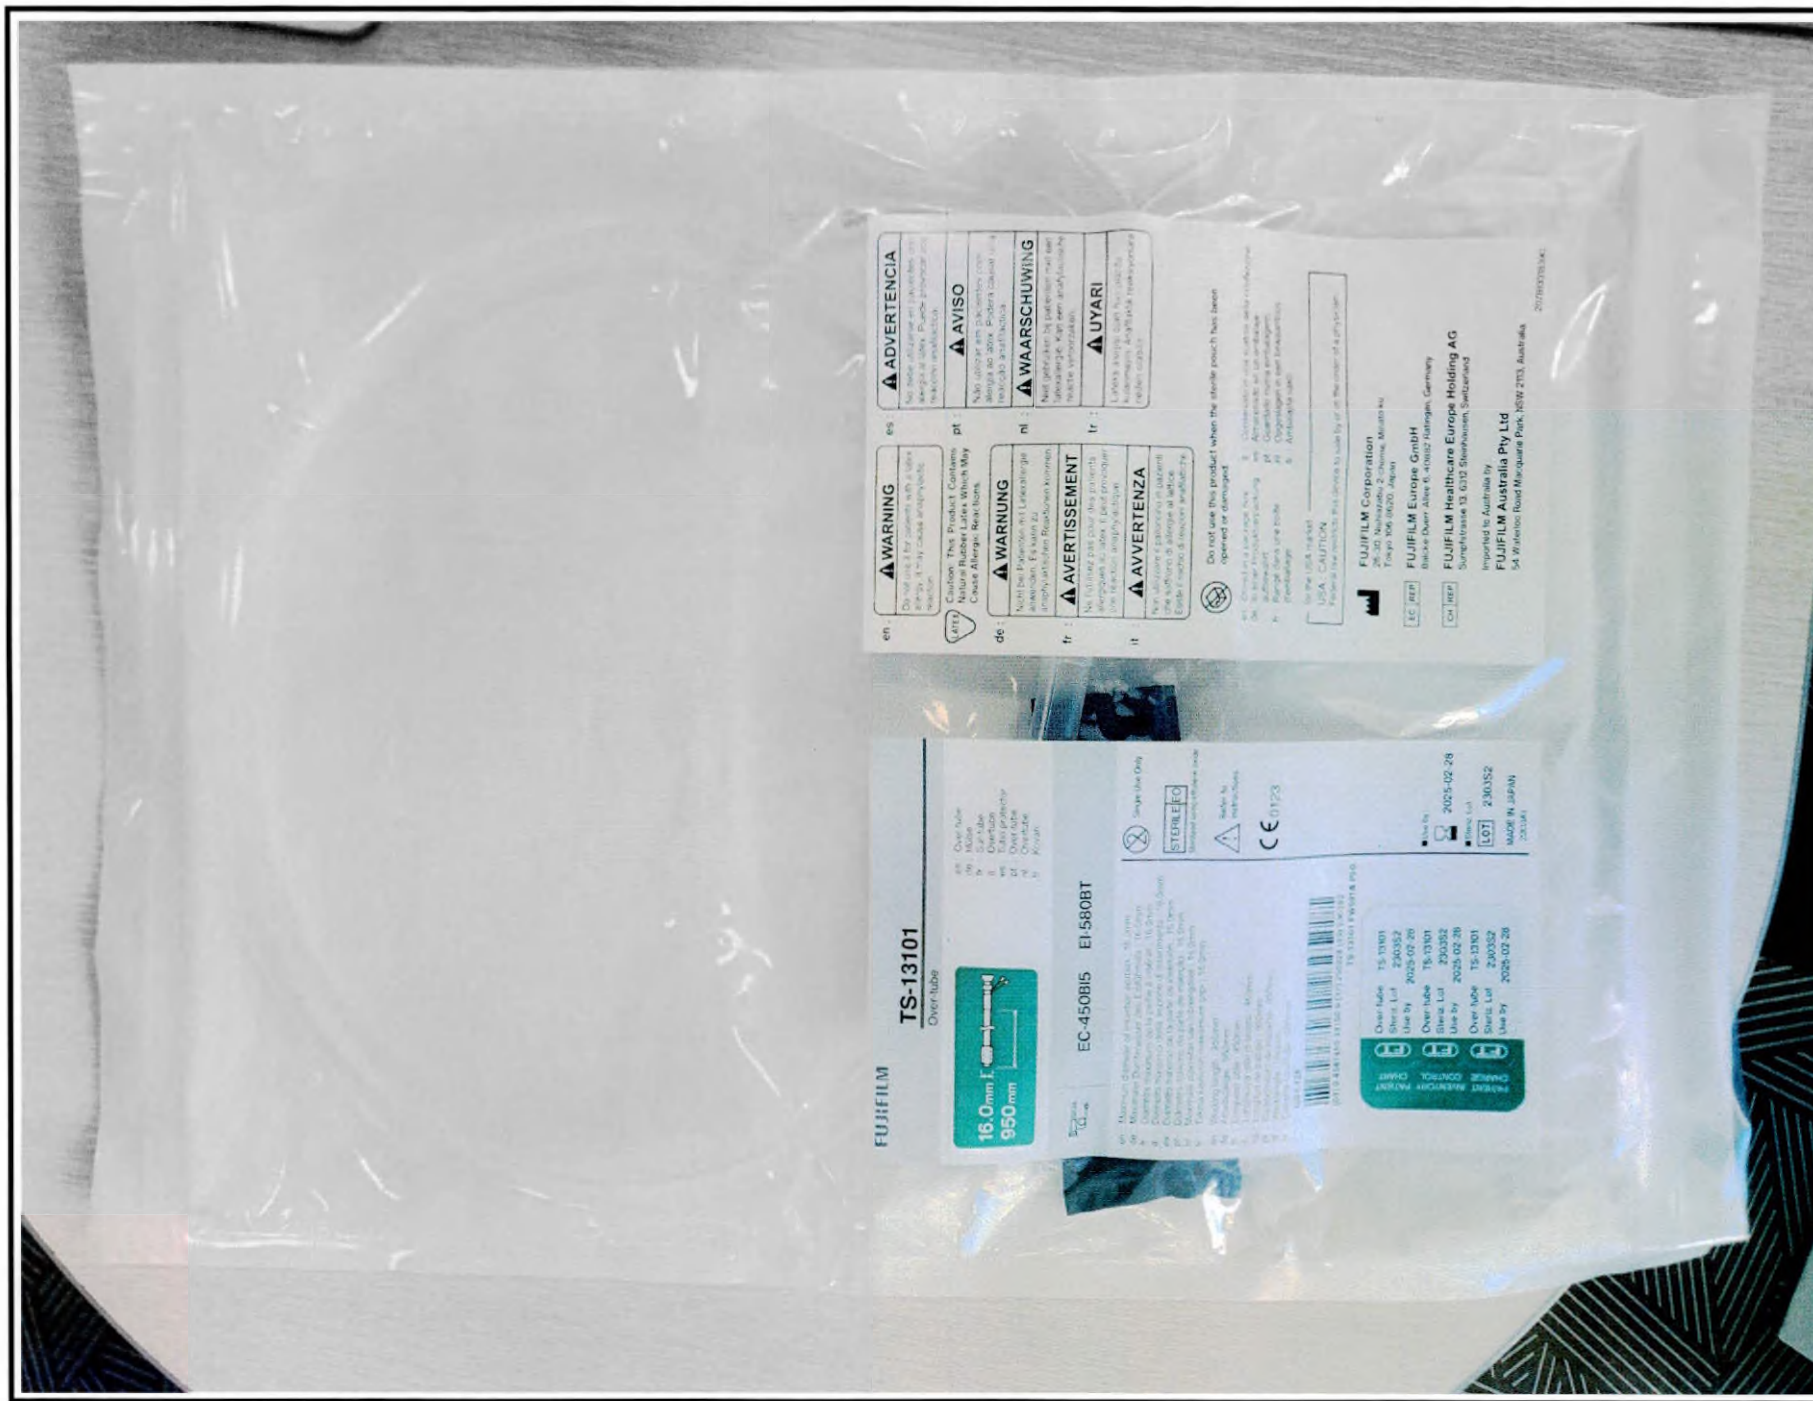

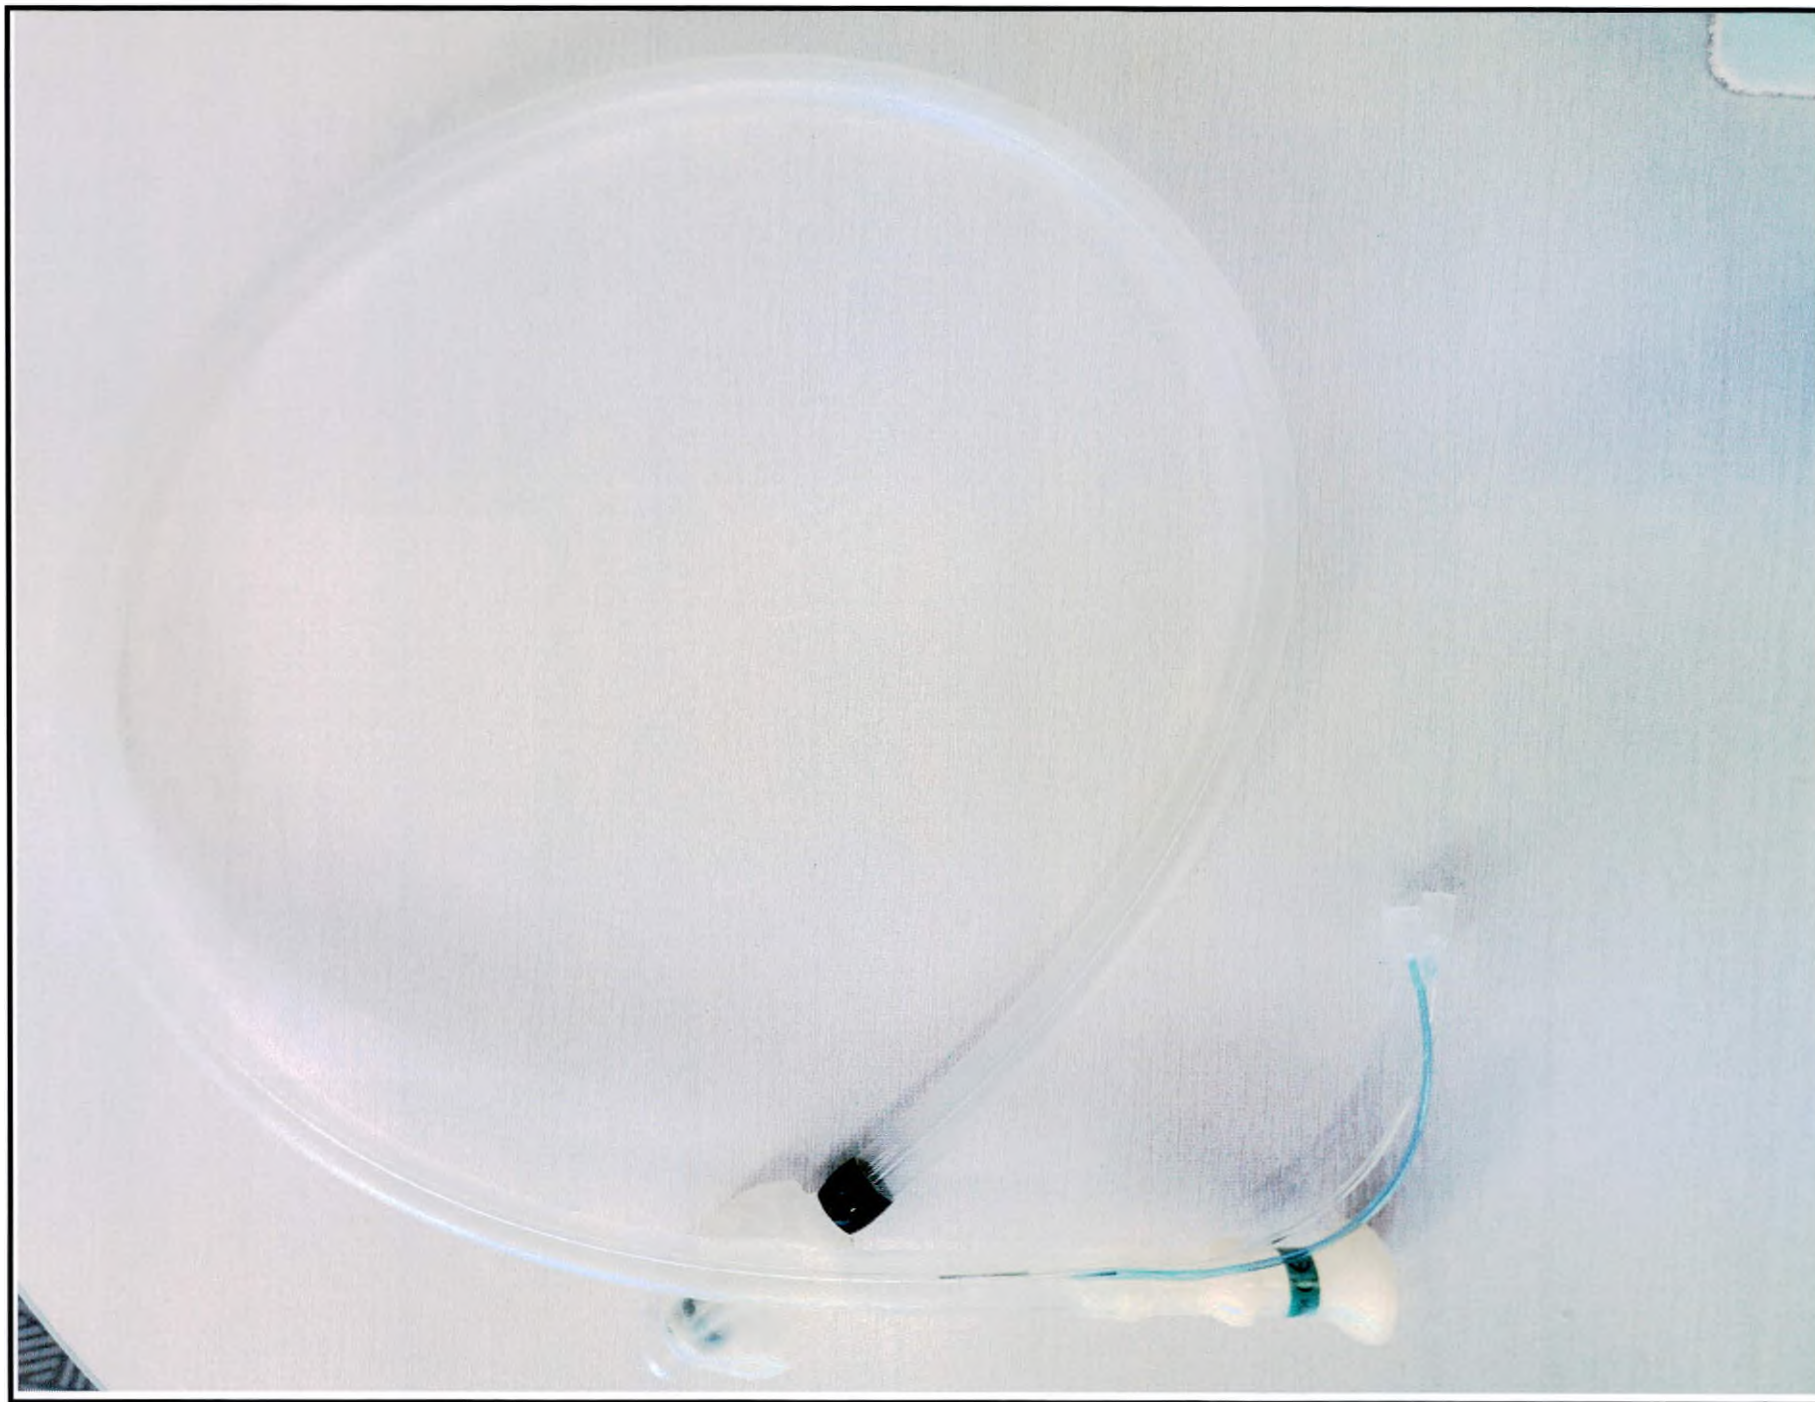



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 135

(ста тридесет и пет) листах



Е. М.

