


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «РЗП»



А.С. Комогорцев

«01» июля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наконечники «TR Tips RZP» нестерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro

Наименование медицинского изделия

Наконечники «TR Tips RZP» нестерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro, варианты исполнения:

Варианты исполнения		
№	Наименование	Количество шт. в упаковке
Вариант исполнения 1	Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл	- 2 пакета по 500 шт.; - руководство по эксплуатации 1 шт.
Вариант исполнения 2	Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл	- 4 пакета по 250 шт.; - руководство по эксплуатации 1 шт.
Вариант исполнения 3	Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 100-1000 мкл	- 2 пакета по 500 шт.; - руководство по эксплуатации 1 шт.

Нормативный документ ТУ 22.29.29-001-07506866-2023

Пример варианта маркировки и упаковки

Вариант исполнения 1

Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл

Фото 1. Внешний вид наконечника «TR Tips RZP»




Фото 2. Потребительская упаковка - коробка



Фото 3. Общий вид медицинского изделия



Фото 4. Компоненты изделия - пакеты

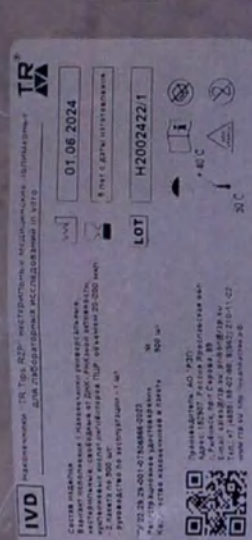

Наименование - ТР Тип РЗР - испытательные металлические материалы для лабораторных исследований *in vitro*

By KENNETH J. PLOTT, Editor, *Journal of Management Education*
HOLT, RINEHART & WINSTON

... ..

В. В. Кривошеин, доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой физики, МГУ им. М. В. Ломоносова

[illegible]


требования к качеству продукции и к качеству обслуживания клиентов, к качеству работы персонала, к качеству работы оборудования и к качеству работы системы управления. В результате этого повышается эффективность работы предприятия и повышается конкурентоспособность продукции.

Институт клинической лабораторной диагностики, Ленинградский университет, Ленинград

[illegible]

IVD	Наконечники "TR Tips RZP" нестерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro		TR
Состав изделия Вариант исполнения 1: Наконечники универсальные, нестерильные, свободные от ДНК-РНКазной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл. - 2 пакета по 500 шт; - руководство по эксплуатации - 1 шт.		 01.06.2024  5 лет с даты изготовления	
ТУ 22.05.05-001-07406866-2023 Регистрационное удостоверение № Количество наконечников в пакете 500 шт		LOT H2002422/1	
	Производитель: АО "РЗП" Адрес: 152907, Россия Ярославская обл. г. Рыбинск, пр-т Серова, 89 E-mail: sales@rzp.su; pribor@rzp.su Тел.: +7 (4855) 55-02-98; 8(962) 210-11-22 www.rzp.su htp://medplastik.rf		 +40°C     50 C


Фото 6. Транспортная упаковка - гофрокороб

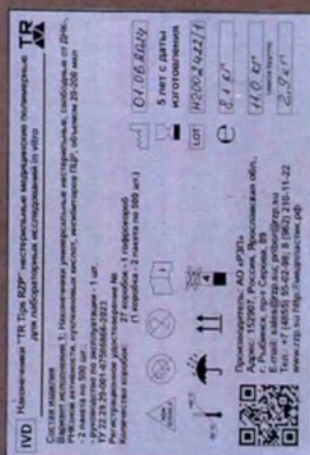

Варианта исполнения 2

Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКазной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл

Фото 1. Внешний вид наконечника «TR Tips RZP»

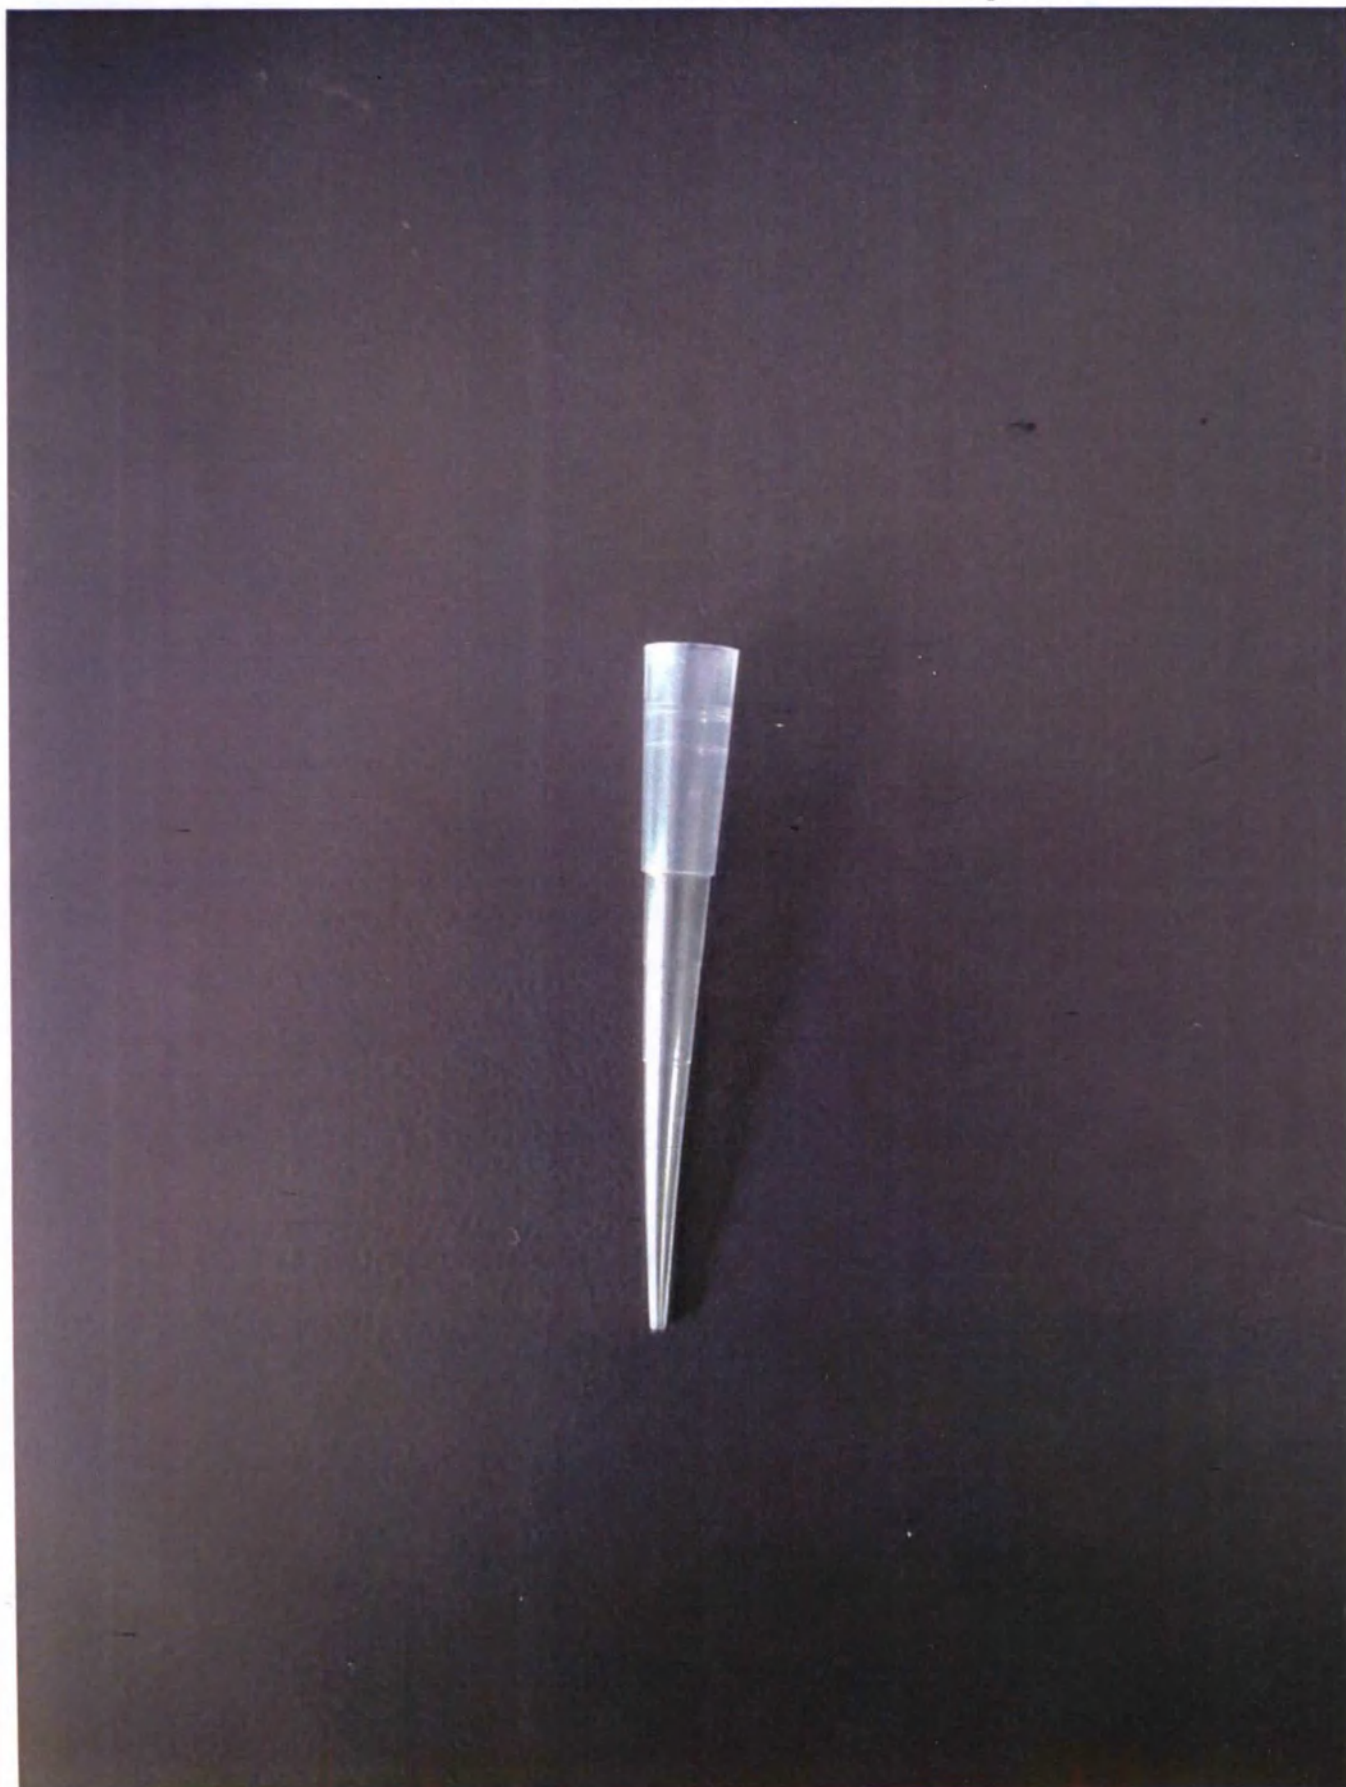

**IVD**Наконечники TR Tips RZP® нестерильные медицинские полимерные
для лабораторных исследований in vitro

Состав изделия
Вариант исполнения 2: Наконечники универсальные,
нестерильные, свободные от ДНК-, РНК-активности,
нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл
- 4 пакета по 250 шт;
- руководство по эксплуатации - 1 шт

ТУ 22.29.29-001-07506866-2023
Регистрационное удостоверение
Количество пакетов в коробке

№
4 пакета по 250 шт



05.05.2024

5 лет с даты изготовления

LOT

H2002419/1



Производитель: АО "РЗП"
Адрес: 152907, Россия Ярославская обл.
г. Рыбинск, пр-т Серова, 89
E-mail: sales@rzp.su; pribor@rzp.su
Тел.: +7 (4855) 55-02-98; 8(962) 210-11-22
www.rzp.su http://medplastik.rf



Фото 3. Общий вид медицинского изделия



Фото 4. Компоненты изделия - пакеты



IVD

Наконечники "TR Tips RZP" нестерильные медицинские полимерные
для лабораторных исследований in vitro



Состав изделия
 Вариант исполнения 2: Наконечники универсальные,
 нестерильные, свободные от ДНК-, РНК-зной активности,
 нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл
 - 4 пакета по 250 шт;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт

ТУ 22.29.29-001-07506866-2023
 Регистрационное удостоверение №
 Количество наконечников в пакете 250 шт



Производитель: АО "РЗП"
 Адрес: 152907, Россия Ярославская обл
 г. Рыбинск, пр-т Серова, 89
 E-mail: sales@rzp.su; pribor@rzp.su
 Тел.: +7 (4855) 55-02-98; 8(962) 210-11-22
 www.rzp.su http://недпластик.рф




05.05.2024

LOT

H2002419/1






 + 40°C
 50°C


 NON
 STERILE



Фото 6. Транспортная упаковка - гофрокороб



IVD Медицинские ТР ТС Eurasian Conformity Certificate
для лабораторных исследований

TR **TA**

Состав изделия
Вариант исполнения 2. Наименование универсальных инструментов, содержащих от 2 до 4 элементов: 1. Лезвие, 2. Рукоятка, 3. Защитный колпачок, 4. Пластина (по 250 шт.)
Упаковка по количеству - 1 шт.
22.25.001.01.000.000.000
Регистрационный номер - 27
Количество коробов: 27 коробов - 1 гофрокороб (1 коробка - 4 пластины по 250 шт.)

Промышленность АО «РЗТ»
Адрес: 152067, Россия, Ярославская обл., Ярославский район, с/пос. Серовское, д. 89
Е-mail: info@rzt.ru, rzt@rzt.ru
Тел.: +7 (4855) 55-42-36, 8 (902) 210-11-22
www.rzt.ru, http://yadrolabs.ru

Символы:

5 шт. с датой изготовления 05.05.2024

100 103024711

Е 8.1.07

71.0 КТ

2.9 КТ

Вариант исполнения 3

Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНК-зной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 100-1000 мкл

Фото 1. Внешний вид наконечника «TR Tips RZP»

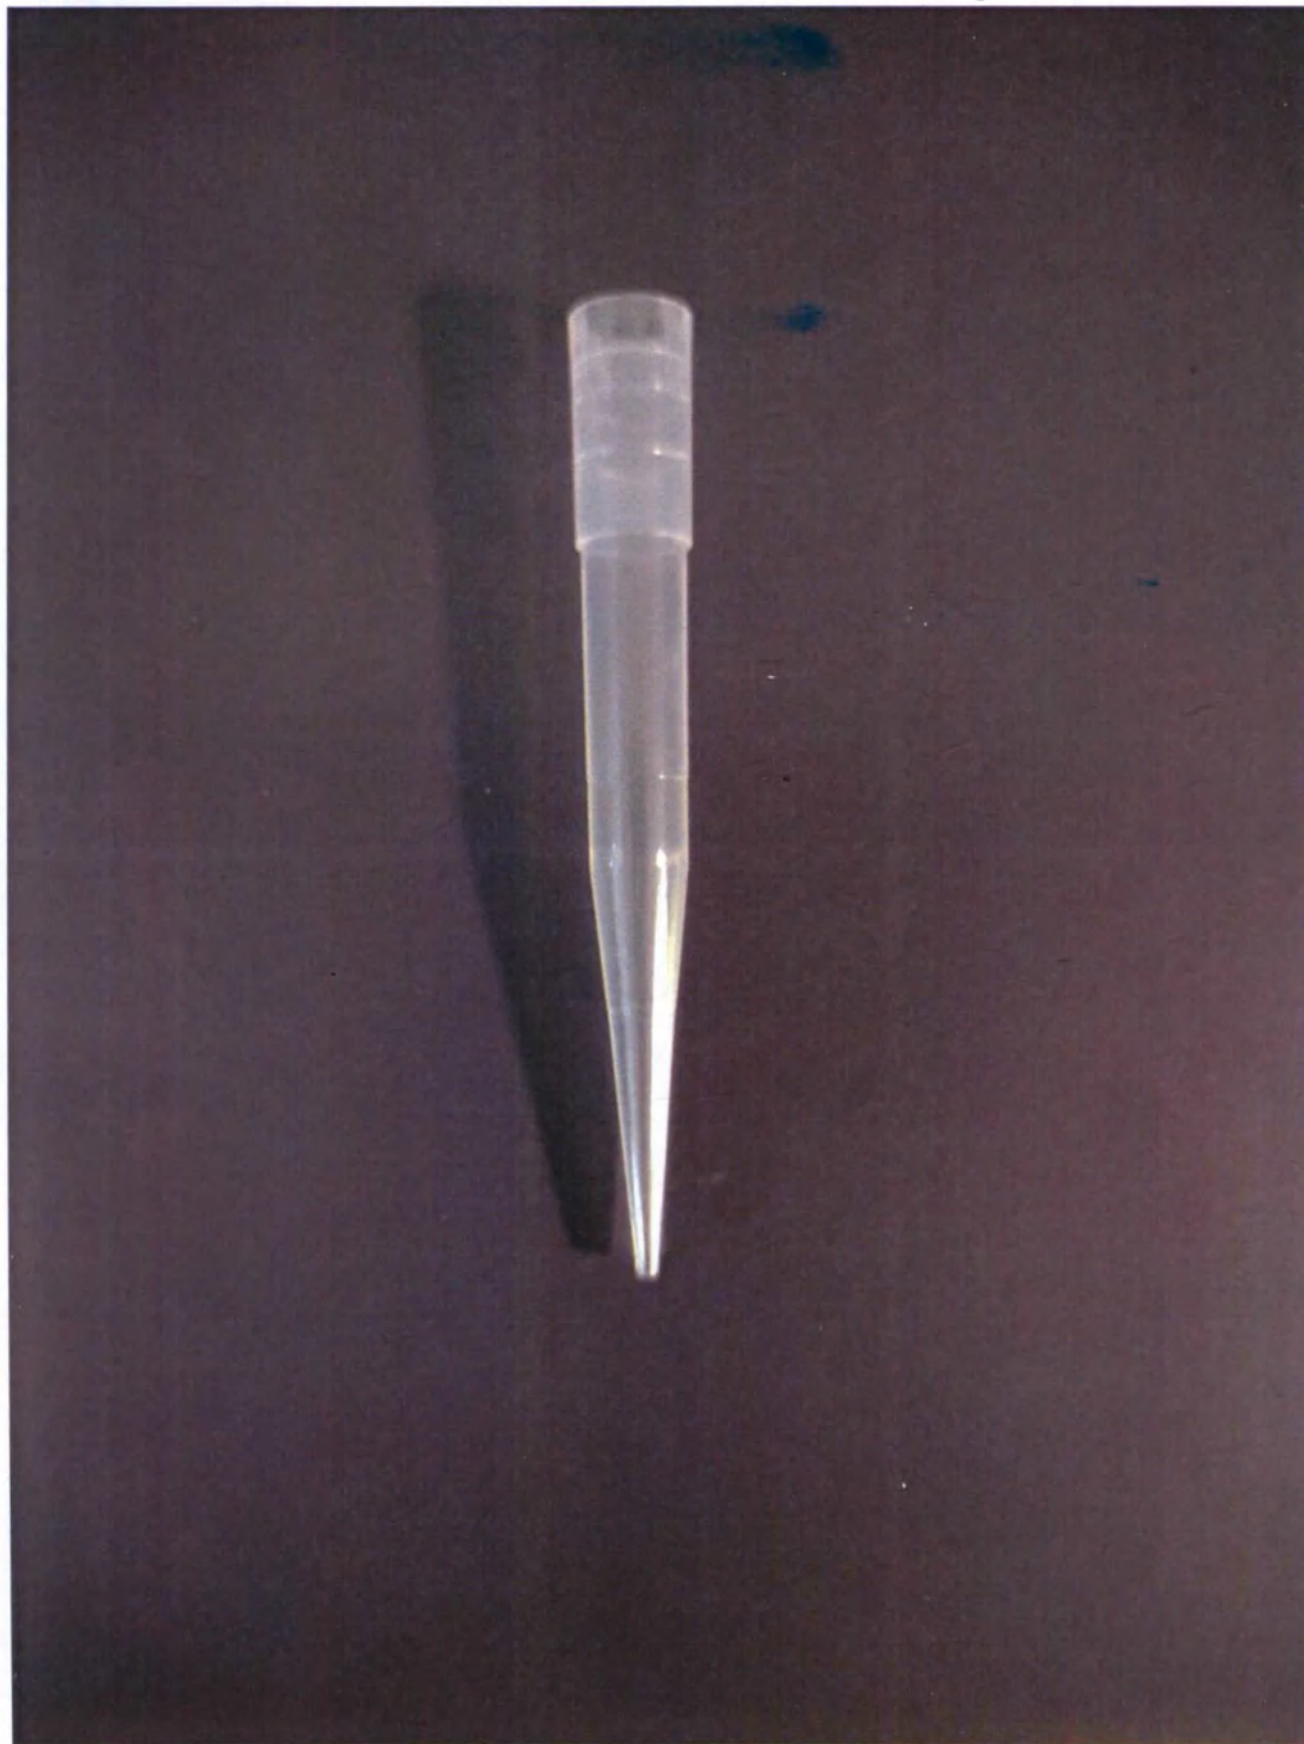


Фото 2. Потребительская упаковка – коробка



Фото 3. Общий вид медицинского изделия




Фото 4. Компоненты изделия - пакеты



Фото 5. Компонент изделия – пакет



Фото 6. Транспортная упаковка - гофрокороб

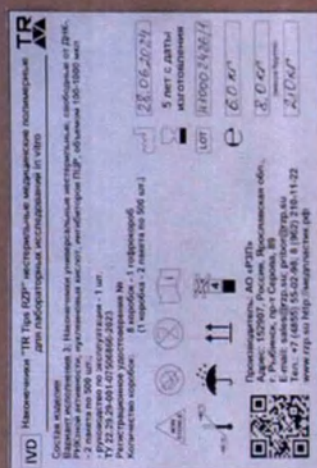

Прошито и скреплено 20 листов


Генеральный директор АО «РЗП»

А.С.Комогорцев



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «РЗП»

 А.С. Комогорцев

« 26 » _____ июня _____ 2024__ г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Наконечники «TR Tips RZP» нестерильные медицинские полимерные
для лабораторных исследований in vitro.**

Наименование медицинского изделия

Наконечники «TR Tips RZP» нестерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro», варианты исполнения:

Варианты исполнения		
№	Наименование	Количество шт. в упаковке
Вариант исполнения 1	Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл	– 2 пакета по 500 шт.; – руководство по эксплуатации 1 шт.
Вариант исполнения 2	Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл	– 4 пакета по 250 шт.; – руководство по эксплуатации 1 шт.
Вариант исполнения 3	Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 100-1000 мкл	– 2 пакета по 500 шт.; – руководство по эксплуатации 1 шт.

Нормативный документ ТУ 22.29.29-001-07506866-2023

Вариант исполнения 1

Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл

Рисунок 1. Макет маркировки компонента изделия – пакет

IVD Наконечники "TR Tips RZP" нестерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro **TR®**

Состав изделия
Вариант исполнения 1: Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл
 - 2 пакета по 500 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.

ТУ 22.29.29-001-07506866-2023
 Регистрационное удостоверение № 500 шт.

Производитель: АО «РЗП»
 Адрес: 152907, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т Серова, 89
 E-mail: sales@rzp.su; pribor@rzp.su
 Тел.: +7 (4855) 55-02-98; 8 (962) 210-11-22
 www.rzp.su http://medplastik.pf

Icons: Temperature range (-50°C to +40°C), Non-sterile, Fragile, No fire, No open flame, No sharp objects.

Дата изготовления

Код партии

QR-код

Линия отреза

4R3

Рисунок 2. Макет маркировки потребительской упаковки - коробка.

IVD Наконечники "TR Tips RZP" нестерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro **TR®**

Состав изделия
Вариант исполнения 1: Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл
 - 2 пакета по 500 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.

ТУ 22.29.29-001-07506866-2023
 Регистрационное удостоверение № 2 пакета по 500 шт.

Производитель: АО «РЗП»
 Адрес: 152907, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т Серова, 89
 E-mail: sales@rzp.su; pribor@rzp.su
 Тел.: +7 (4855) 55-02-98; 8 (962) 210-11-22
 www.rzp.su http://medplastik.pf

Icons: Temperature range (-50°C to +40°C), Non-sterile, Fragile, No fire, No open flame, No sharp objects.

Дата изготовления

Код партии

QR-код

Линия отреза

4R3

Рисунок 3. Макет маркировки транспортной упаковки - гофрокороб

IVD Наконечники "TR Tips RZP" нестерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro **TR®**

Состав изделия
Вариант исполнения 1: Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл
 - 2 пакета по 500 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.

ТУ 22.29.29-001-07506866-2023
 Регистрационное удостоверение № 27 коробок - 1 гофрокороб (1 коробка - 2 пакета по 500 шт.)

Производитель: АО «РЗП»
 Адрес: 152907, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т Серова, 89
 E-mail: sales@rzp.su; pribor@rzp.su
 Тел.: +7 (4855) 55-02-98; 8 (962) 210-11-22
 www.rzp.su http://medplastik.pf

Icons: Temperature range (-50°C to +40°C), Non-sterile, Fragile, No fire, No open flame, No sharp objects.

Линия отреза

Дата изготовления

Код партии

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто потребительской упаковки

QR-код

Линия отреза

Вариант исполнения 2

Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл

Рисунок 1. Макет маркировки компонента изделия – пакет



Рисунок 2. Макет маркировки потребительской упаковки- коробка



Рисунок 3. Макет маркировки транспортной упаковки - гофрокороб



Вариант исполнения 3

Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 100-1000 мкл.

Рисунок 1. Макет маркировки компонента изделия – пакет



Рисунок 2. Макет маркировки потребительской упаковки - коробка




Рисунок 3. Макет маркировки транспортной упаковки - гофрокороб



Прошито и скреплено 5 листов

Генеральный директор АО «РЗП»


_____ А.С.Комогорцев

