

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ПлазмоВита»

Мехтиева Д. М.

15 марта 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия


«Центрифуга медицинская лабораторная KJLC-I»




Центрифуга медицинская лабораторная KJLC-I



Шнур электропитания

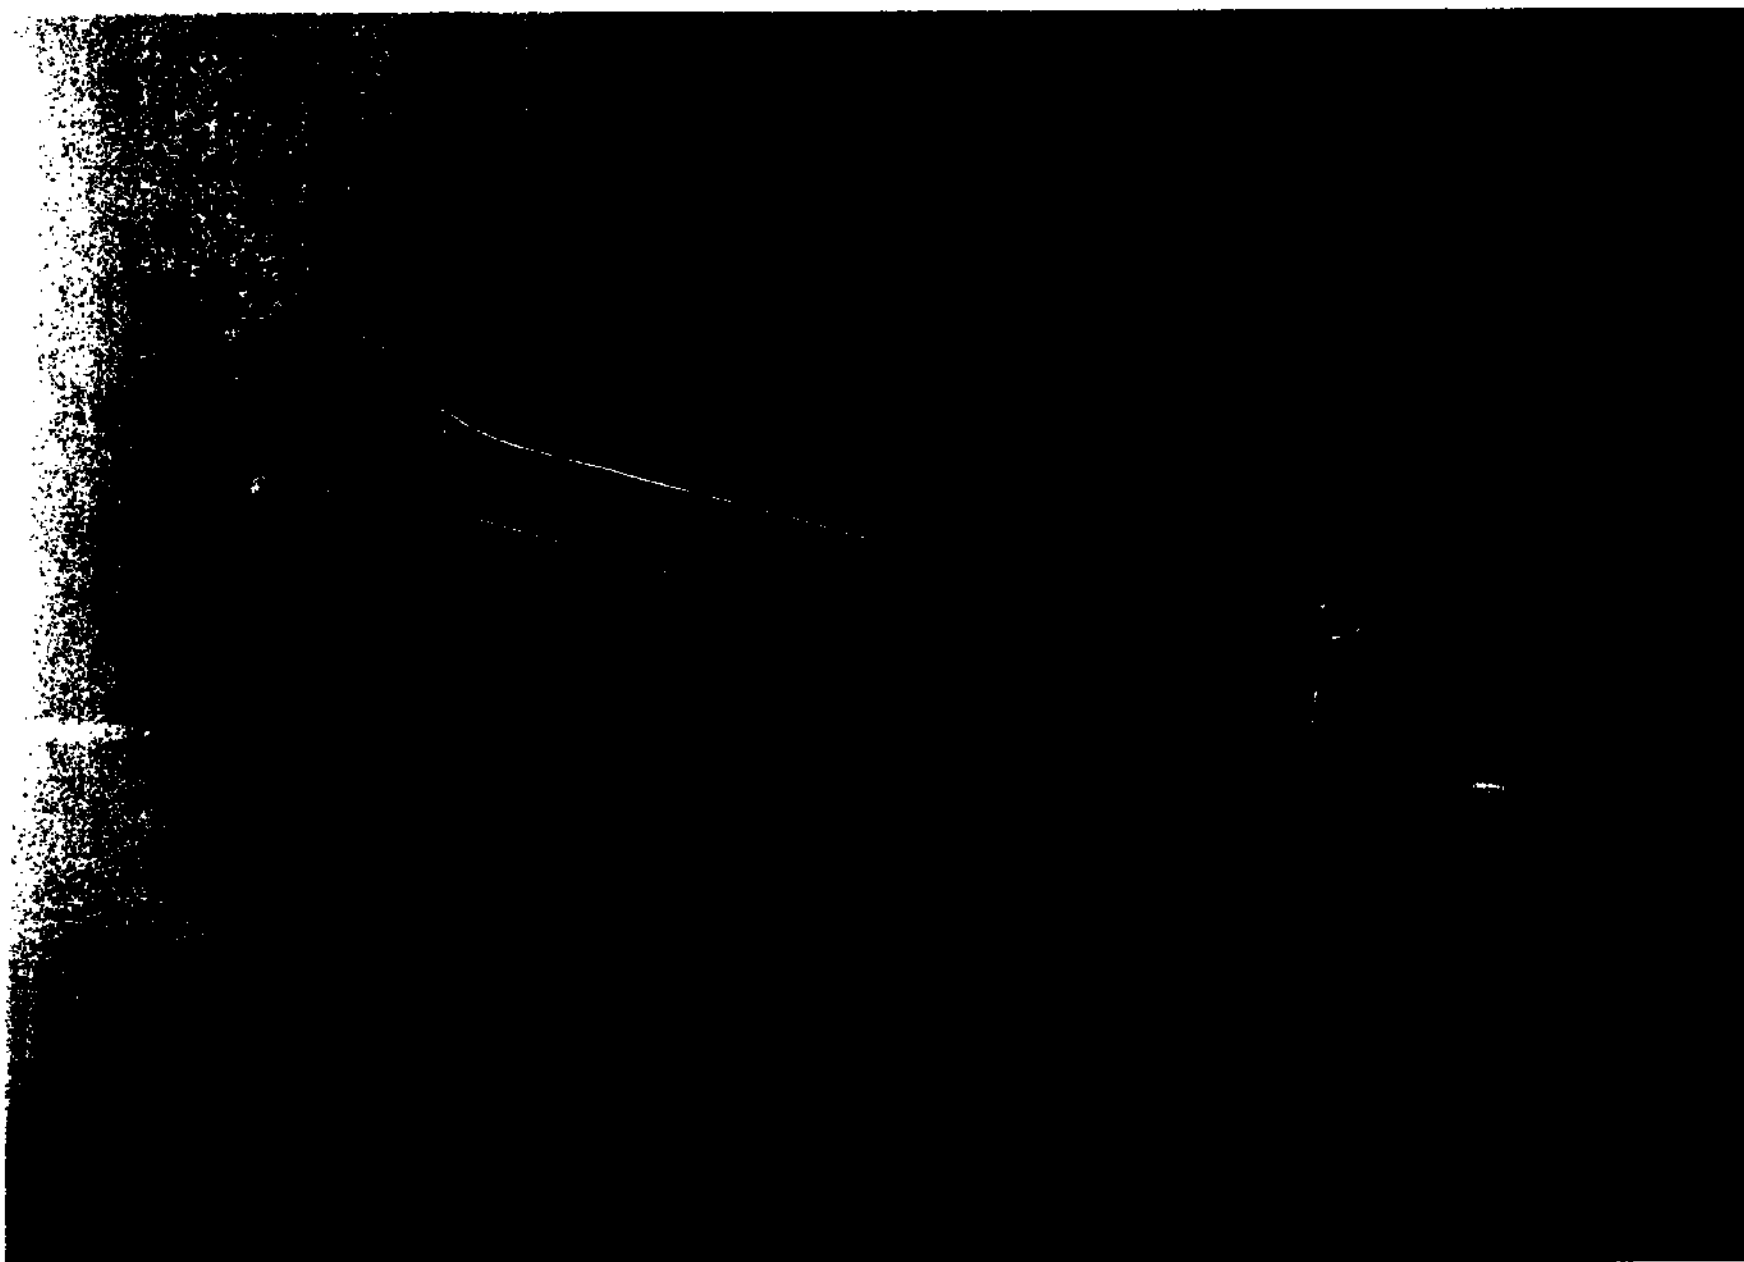

Ключ гаечный №14

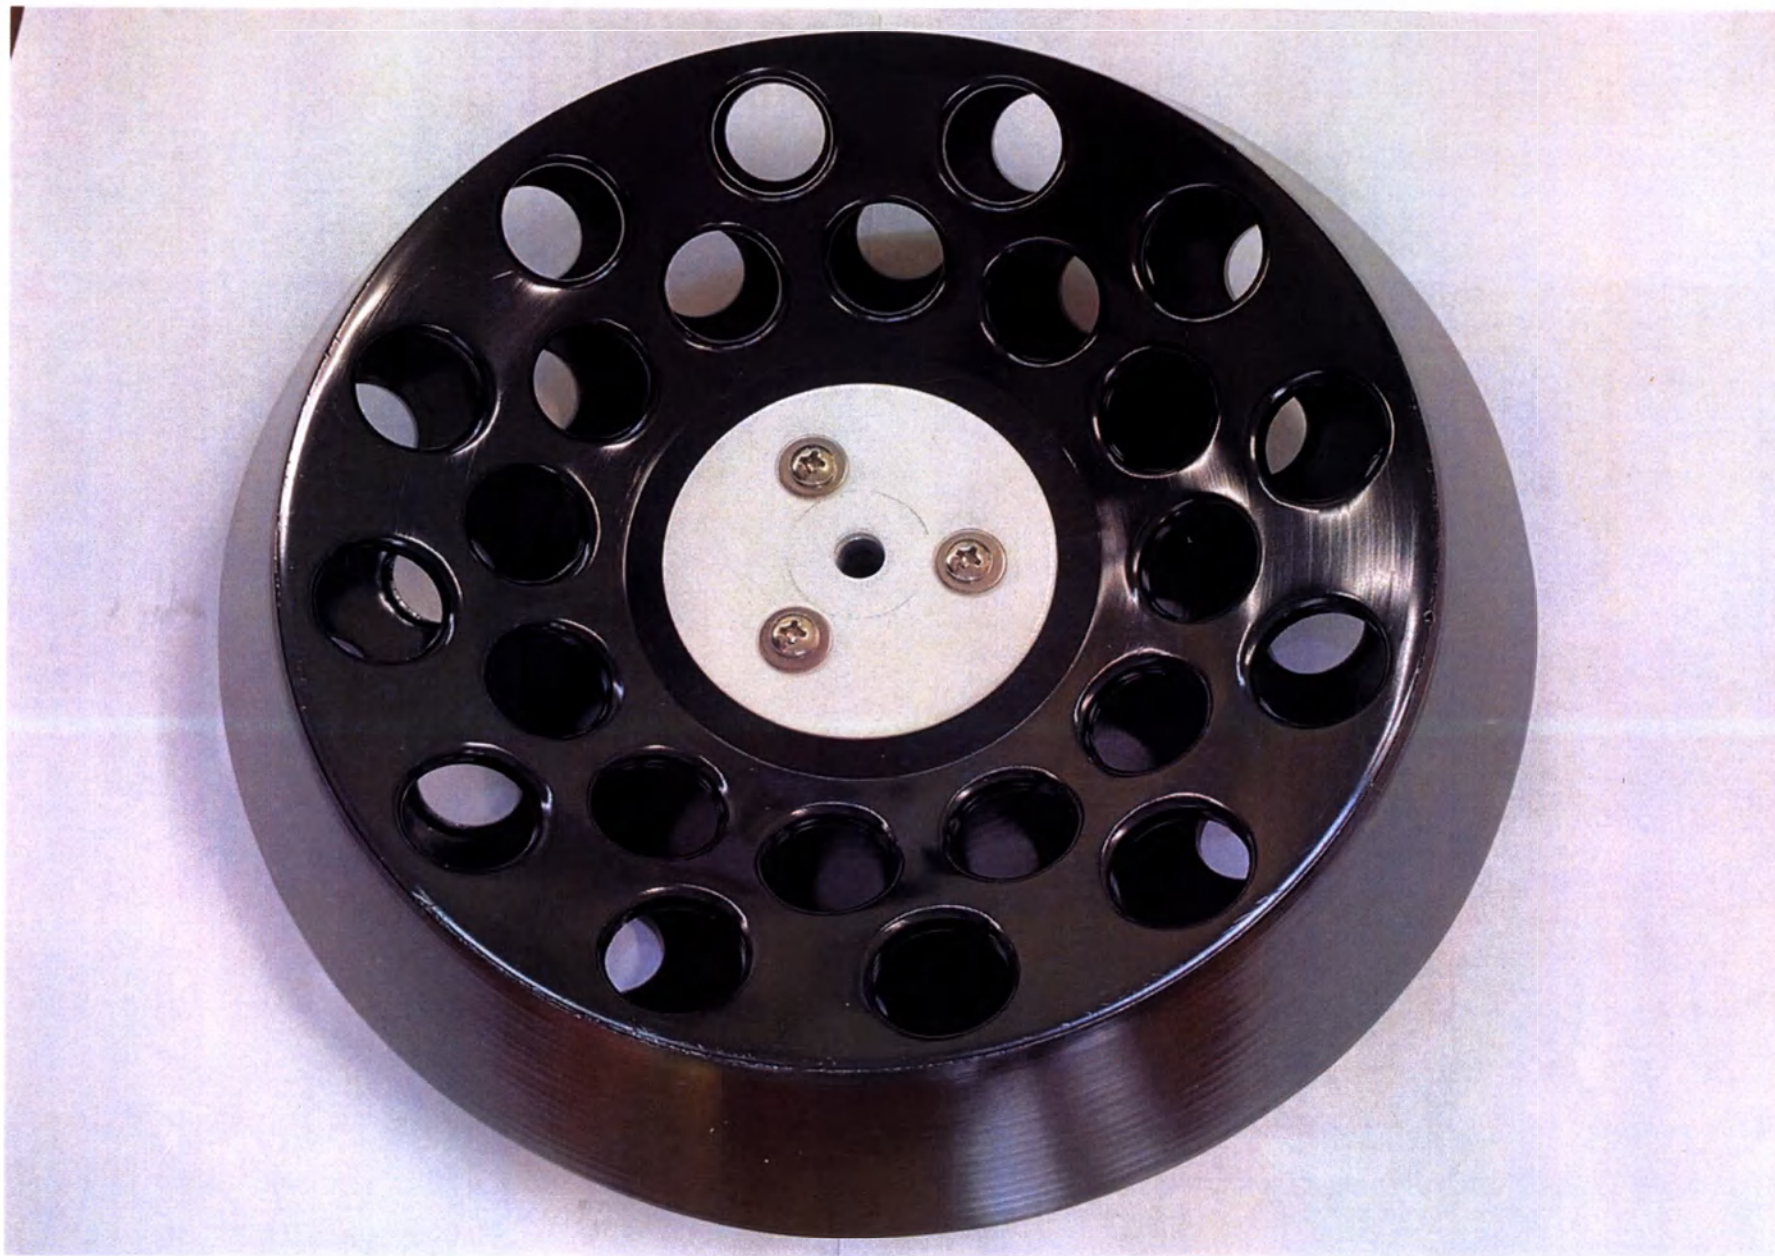

Ротор угловой с 24 лунками



Штатив Ø16 x 85 мм (для ротора углового с 24 лунками)



Прокладка резиновая 27 мм (для роторов угловых с 12 и 24 лунками)




Ротор угловой с 12 лунками



Штатив $\varnothing 17 \times 105$ мм (для ротора углового с 12 лунками)



Прокладка резиновая 48 мм —(для ротора углового с 12 лунками)

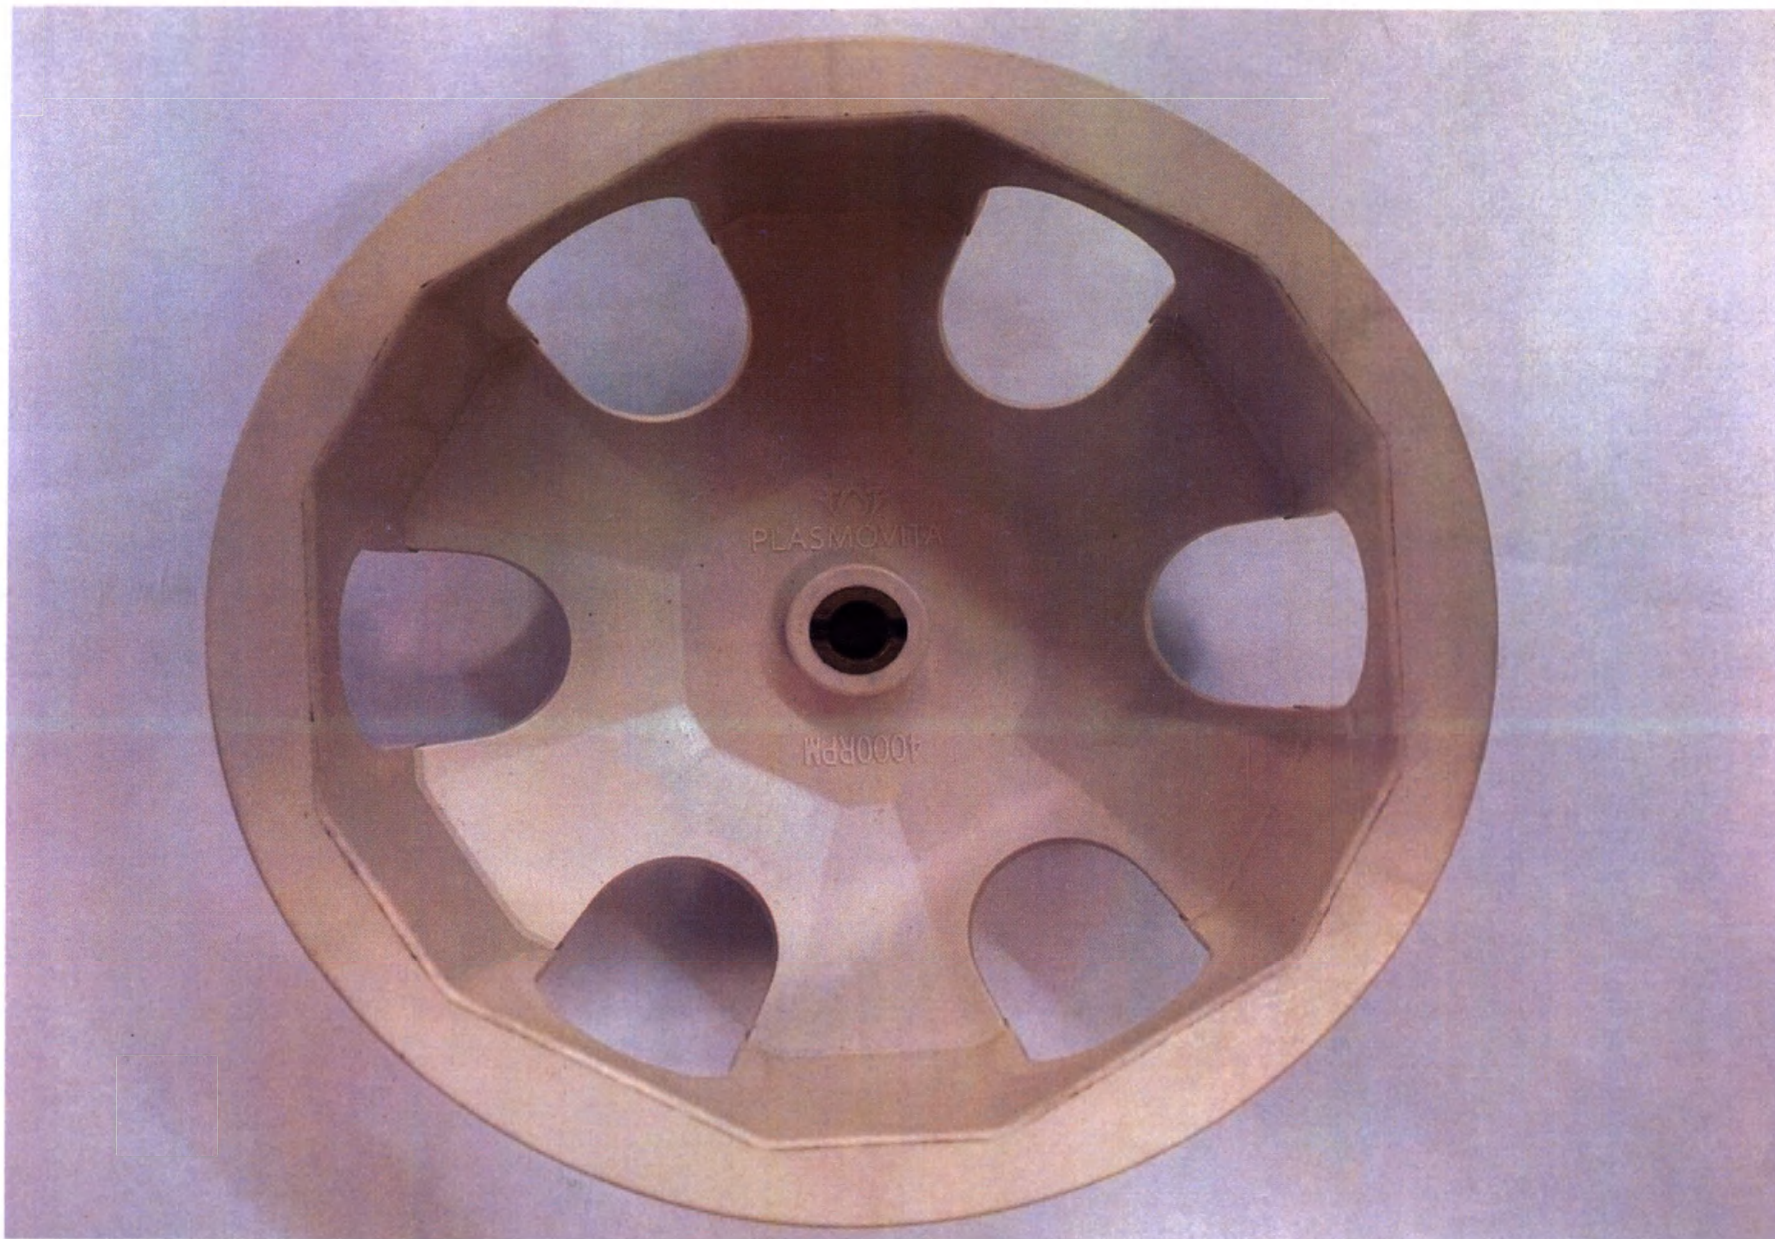

Ротор горизонтальный с 6 лунками



Штатив 16,5 x 82,7 мм (для ротора горизонтального с 6 лунками)

KANG JIAN Руководство по эксплуатации центрифуги медицинской лабораторной KJLC-I



KJLC-I


Руководство по эксплуатации



Авторское право 2014 г. Все права защищены.

Серийный номер: 201412-EN-A

1

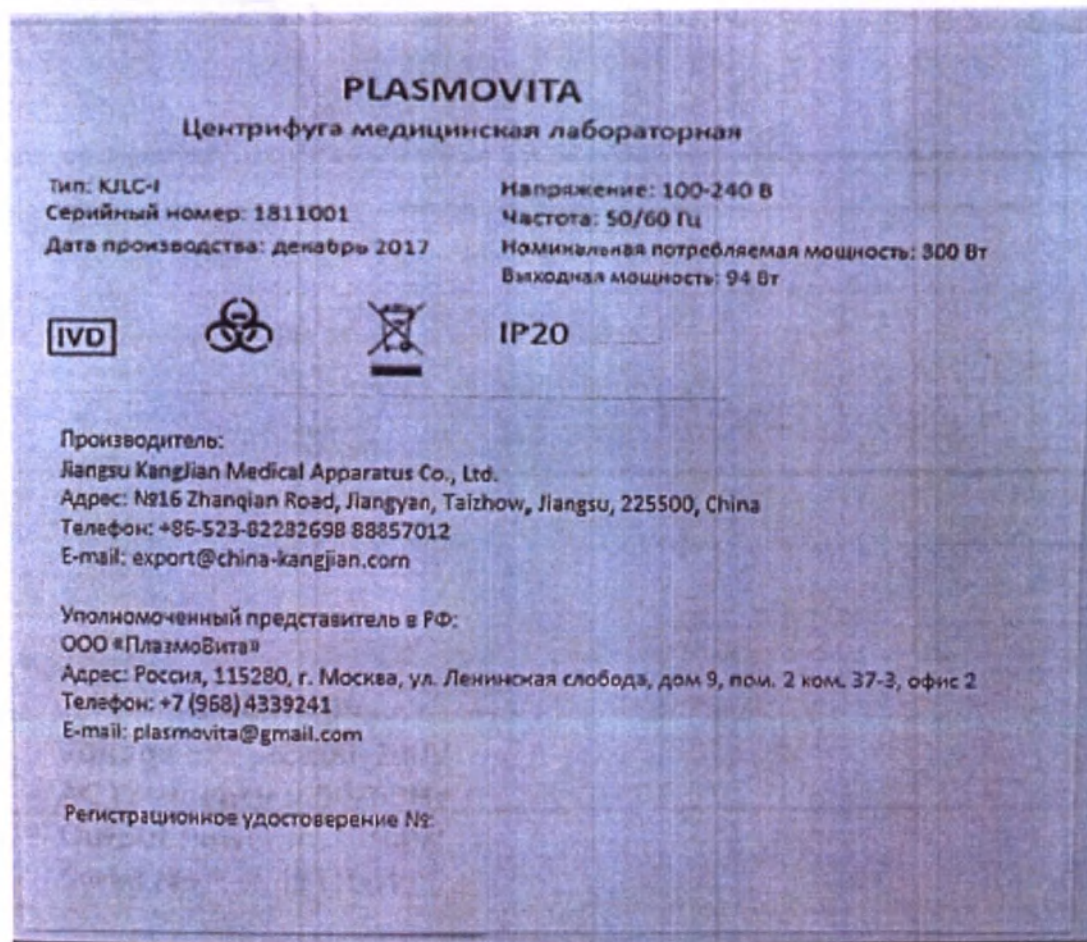

Фотография маркировки

