



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 февраля 2024 года № РЗН 2022/17687

На медицинское изделие

Центрифуги в вариантах исполнения NF 048, NF 200, NF 400, NF400R,
с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ММ Рус"

(ООО "ММ Рус"), Россия,

125124, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля,
д. 2, к. 26

Производитель

"Нюве Санайи Малземелери Ималат ве Тиджарет Аноним Ширкети", Турция,
Nüve Sanayi Malzemeleri İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi, Saracalar Mahallesi,
Saracalar Kümeevleri No:4/2 Akyurt, Ankara, Turkey

Место производства медицинского изделия

Nüve Sanayi Malzemeleri İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi, Saracalar Mahallesi,
Saracalar Kümeevleri No:4/2 Akyurt, Ankara, Turkey

Номер регистрационного досье № РД-60691/4907 от 06.02.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 28.29.41.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 08 февраля 2024 года № 521
допущено к обращению на территории Российской Федерации
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0075348

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 февраля 2024 года № РЗН 2022/17687

Лист 1

На медицинское изделие

**Центрифуги в вариантах исполнения NF 048, NF 200, NF 400, NF400R,
с принадлежностями, в вариантах исполнения:**

1. Центрифуга NF 048 с принадлежностями, в составе:

1.1. Центрифуга NF 048.

1.2. Кабель силовой.

1.3. Инструмент для ручного открытия крышки - не более 2 шт.

1.4. Руководство пользователя.

Принадлежности:

1. Угловой ротор (микролитровый) 24x1.5/2 мкл, максимальный диаметр пробирки 11 мм - не более 3 шт.

2. Гематокритный ротор на 24 капиллярные пробирки максимальный диаметр пробирки 0,75 мм - не более 3 шт.

3. Адаптер, для пробирок максимального диаметра 8 мм, емкостью 1x500 /800 мкл - не более 48 шт.;

4. Адаптер, для пробирок максимального диаметра 6 мм емкостью 1x250/400/700 мкл - не более 48 шт.

5. Адаптер для ПЦР пробирок максимального диаметра 6,5 мм, емкостью 1x200 мкл - не более 48 шт.

2. Центрифуга NF 200 с принадлежностями, в составе:

2.1. Центрифуга NF 200.

2.2. Кабель силовой.

2.3. Инструмент для ручного открытия крышки - не более 2 шт.

2.4. Руководство пользователя.

Принадлежности:

1. Адаптер для пробирок максимального диаметра 11 мм, емкостью 1,5 / 2 мл - не более 24 шт.

2. Адаптер для вакуумных/без вакуума пробирок максимального диаметра 13 мм объемом 7 мл - не более 24 шт.

3. Адаптер для вакуумных/без вакуума пробирок максимального диаметра 13 мм объемом 5 мл - не более 24 шт.

3. Центрифуга NF 400 с принадлежностями, в составе:


3.1. Центрифуга NF 400.

3.2. Кабель силовой.

3.3. Инструмент для ручного открытия крышки - не более 2 шт.

3.4. Ключ гаечный для замены ротора - не более 2 шт. в составе.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

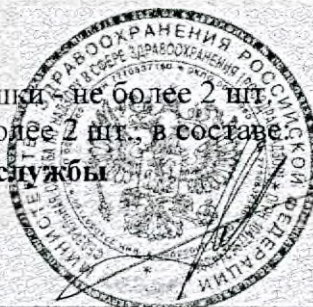

Д.Ю. Павлюков

0133728

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 февраля 2024 года № РЗН 2022/17687

Лист 2

3.4.1. Ключ гаечный.

3.4.2. Ключ торцевой 24.

3.5. Масло для смазки - не более 10 шт.

3.6. Руководство пользователя.

Принадлежности:

1. Поворотный ротор RA 100 - не более 3 шт.

2. Устройство для извлечения ротора - не более 2 шт.

3. Набор из 4-х вставок для пробирок 1x100 мл - не более 4 шт.

4. Набор из 4-х вставок для пробирок конических 1x50 мл - не более 4 шт.

5. Набор из 4-х вставок для пробирок 4x 15 мл - не более 4 шт.

6. Набор из 4-х вставок для пробирок конических 2x15 мл - не более 4 шт.

7. Набор из 4-х вставок для пробирок 17x5 мл (для РИА) - не более 4 шт.

8. Набор из 4-х вставок для пробирок 4x7 мл - не более 4 шт.

9. Набор из 4-х вставок для пробирок 4x5 мл - не более 4 шт.

10. Ротор для микротитрования планшетов MP 100 - не более 3 шт.

11. Угловой ротор RS 240, 16x15 мл для пробирок максимального диаметра 17 мм - не более 3 шт.

12. Угловой ротор AR 450 30x15 мл для пробирок максимального диаметра 17 мм - не более 3 шт.

13. Адаптер для пробирок объемом 1,5 / 2 мл максимального диаметра 11 мм - не более 60 шт.

14. Адаптер для 7 мл вакуумных пробирок/ пробирок без вакуума максимального диаметра 13 мм - не более 60 шт.

15. Адаптер для 5 мл вакуумных пробирок/ пробирок без вакуума максимального диаметра 13 мм - не более 60 шт.

4. Центрифуга NF 400R с принадлежностями, в составе:

4.1. Центрифуга NF 400R.

4.2. Кабель силовой.

4.3. Инструмент для ручного открытия крышки - не более 2 шт.

4.4. Ключ гаечный для замены ротора - не более 2 шт., в составе:

4.4.1. Ключ гаечный.

4.4.2. Ключ торцевой 24.

4.5. Масло для смазки - не более 10 шт.

4.6. Руководство пользователя

Принадлежности:

1. Поворотный ротор RA 100 - не более 3 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0133729

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 февраля 2024 года № РЗН 2022/17687

Лист 3

2. Устройство для извлечения ротора - не более 2 шт.
3. Набор из 4-х вставок для пробирок 1x100 мл - не более 4 шт.
4. Набор из 4-х вставок для пробирок конических 1x50 мл - не более 4 шт.
5. Набор из 4-х вставок для пробирок 4x 15 мл - не более 4 шт.
6. Набор из 4-х вставок для пробирок конических 2x15 мл - не более 4 шт.
7. Набор из 4-х вставок для пробирок 17x5 мл (для РИА) - не более 4 шт.
8. Набор из 4-х вставок для пробирок 4x7 мл - не более 4 шт.
9. Набор из 4-х вставок для пробирок 4x5 мл - не более 4 шт.
10. Ротор для микротитрования планшетов MP 100 - не более 3 шт.
11. Угловой ротор RS 240, 16x15 мл для пробирок максимального диаметра 17 мм - не более 3 шт.
12. Угловой ротор AR 450 30x15 мл для пробирок максимального диаметра 17 мм - не более 3 шт.
13. Адаптер для пробирок объемом 1,5 / 2 мл максимального диаметра 11 мм - не более 60 шт.
14. Адаптер для 7 мл вакуумных пробирок/ пробирок без вакуума максимального диаметра 13 мм - не более 60 шт.
15. Адаптер для 5 мл вакуумных пробирок/ пробирок без вакуума максимального диаметра 13 мм - не более 60 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0133730